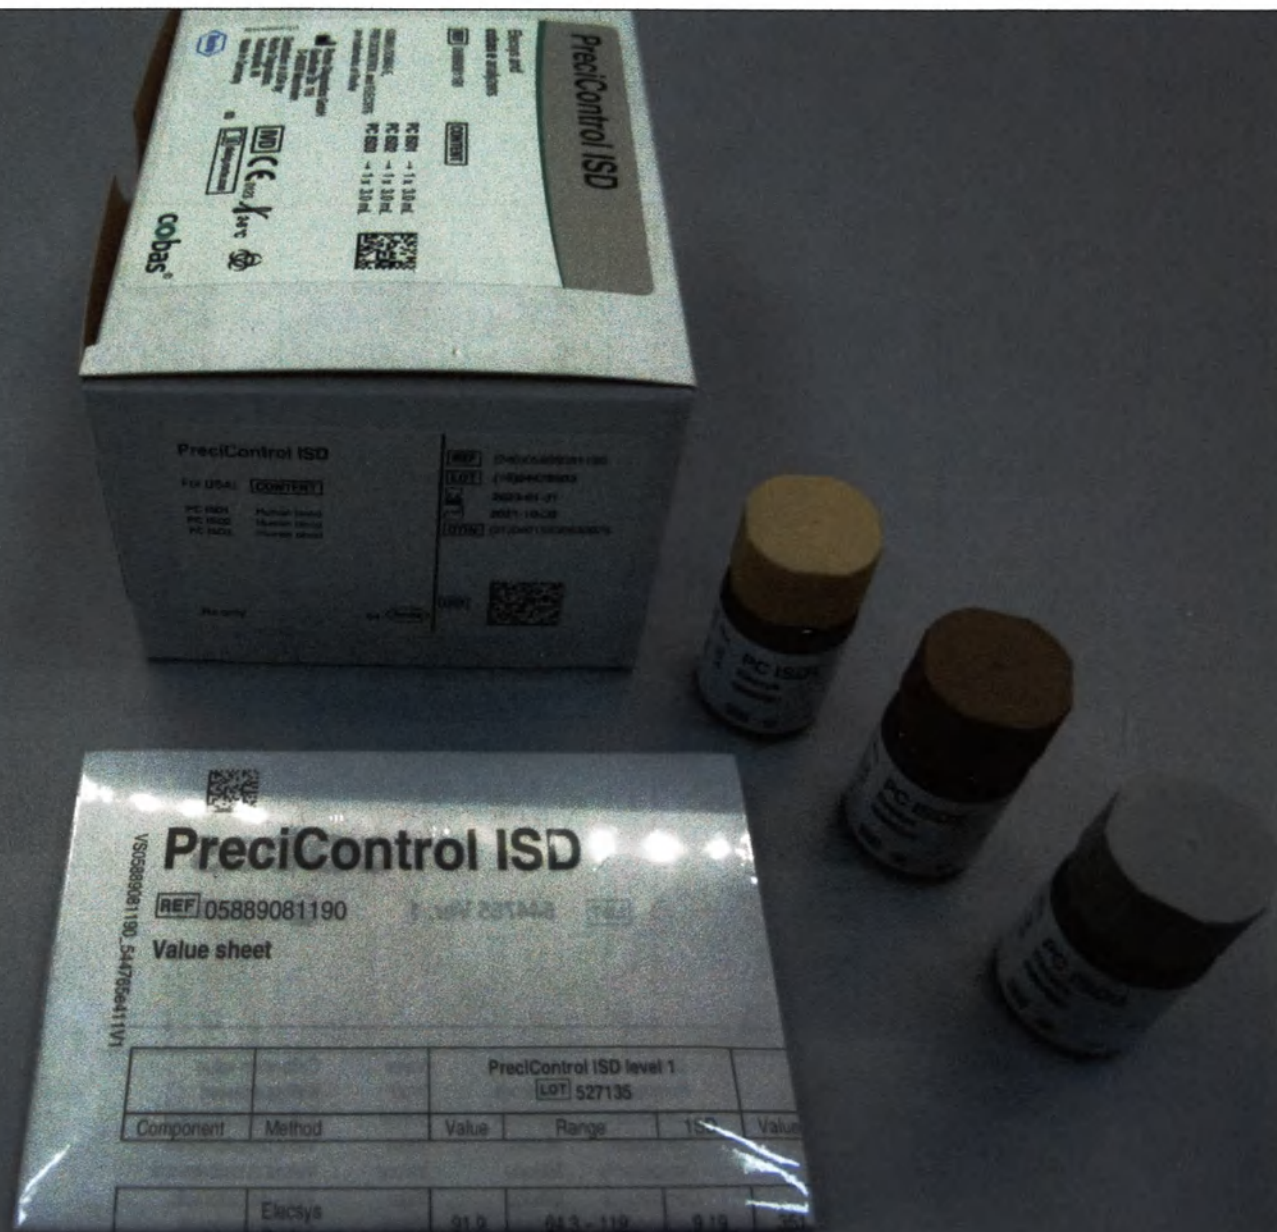


Фотографические изображения

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers)

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PeciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers)



Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers) – маркировка лицевой стороны коробки

PreciControl ISD

cobas e analyzers

REF 05889081190

CONTENT

PC ISD1 → 1 x 3.0 mL

PC ISD2 → 1 x 3.0 mL

PC ISD3 → 1 x 3.0 mL



COBAS, COBAS E,
PRECICONTROL and ELECSYS
are trademarks of Roche.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

06444857001(1)

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany



dialog.roche.com

04



cobas[®]

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PrciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers) – маркировка боковой стороны коробки

PrciControl ISD		REF (240)05889081190
For USA: CONTENT		LOT (10)00000000
PC ISD1	Human blood	2000-01-31
PC ISD2	Human blood	2000-01-01
PC ISD3	Human blood	GTIN (01)04015630930975
Rx only	04	UDI

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PrciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers) – макет стикера на русском языке

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения циклоспорина, такролимуса и сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PrciControl ISD Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Контрольная сыворотка 1 (PC ISD 1), флакон объем 3,0 мл. - 1 шт.
2. Контрольная сыворотка 2 (PC ISD 2), флакон объем 3,0 мл. - 1 шт.
3. Контрольная сыворотка 3 (PC ISD 3) флакон объем 3,0 мл. - 1 шт.
4. Инструкция по применению
5. Паспорт присвоенных значений
6. Этикетка со штрих-кодом - 30 шт.
7. Карта со штрих-кодом - 3 шт.
8. Лист со штрих-кодом.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11601 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05889081190

Контрольная сыворотка 1 (PC ISD 1), флакон объем 3,0 мл - 1 шт. - маркировка



2000-01-31



00000000



2-8 °C

PC ISD1

Elecsys

05889081

→ 3.0 mL



02



Контрольная сыворотка 2 (PC ISD 2), флакон объем 3,0 мл - 1 шт. - маркировка



2000-01-31



00000000



2-8 °C

PC ISD2

Elecsys

05889081

→ 3.0 mL



02



1. Контрольная сыворотка 3 (PC ISD 3), флакон объем 3,0 мл - 1 шт.



2000-01-31



00000000



2-8 °C

PC ISD3

Elecsys

05889081

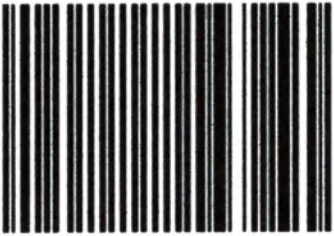
→ 3.0 mL

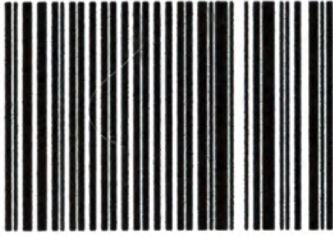


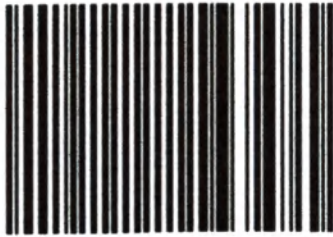
02



Листок со штрих-кодом - 30 шт.

PC ISD3		05889081	
 2000-01-31		LOT 00000000	
			
0000001000000 3000000001			
			

PC ISD1		05889081	
 2000-01-31		LOT 00000000	
			
0000001000000 2800000001			
			

PC ISD2		05889081	
 2000-01-31		LOT 00000000	
			
0000001000000 2900000001			
			

та со штрих-кодом - 3 шт.

PC ISD1

cobas e analyzers

05889081

LOT 000000

Reche

02



PC ISD2

cobas e analyzers

05889081

LOT 000000

Reche

02



PC ISD3

cobas e analyzers

05889081

LOT 000000

Reche

02



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)



Максимов Е.А.
по доверенности
от 30.01.2023 г.