

Фотографические изображения

«Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers)»

Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers)

FSH CalSet II

cobas e analyzers

REF 09557440190

H317,H412
P261,P273,P280
P333+P313,P362+P364
P501

CONTENT

FSH Cal1 → 2 x 1.0 mL
FSH Cal2 → 2 x 1.0 mL



COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE** 0123  2-8 °C


 dialog.roche.com

01



cobas[®]

Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers)

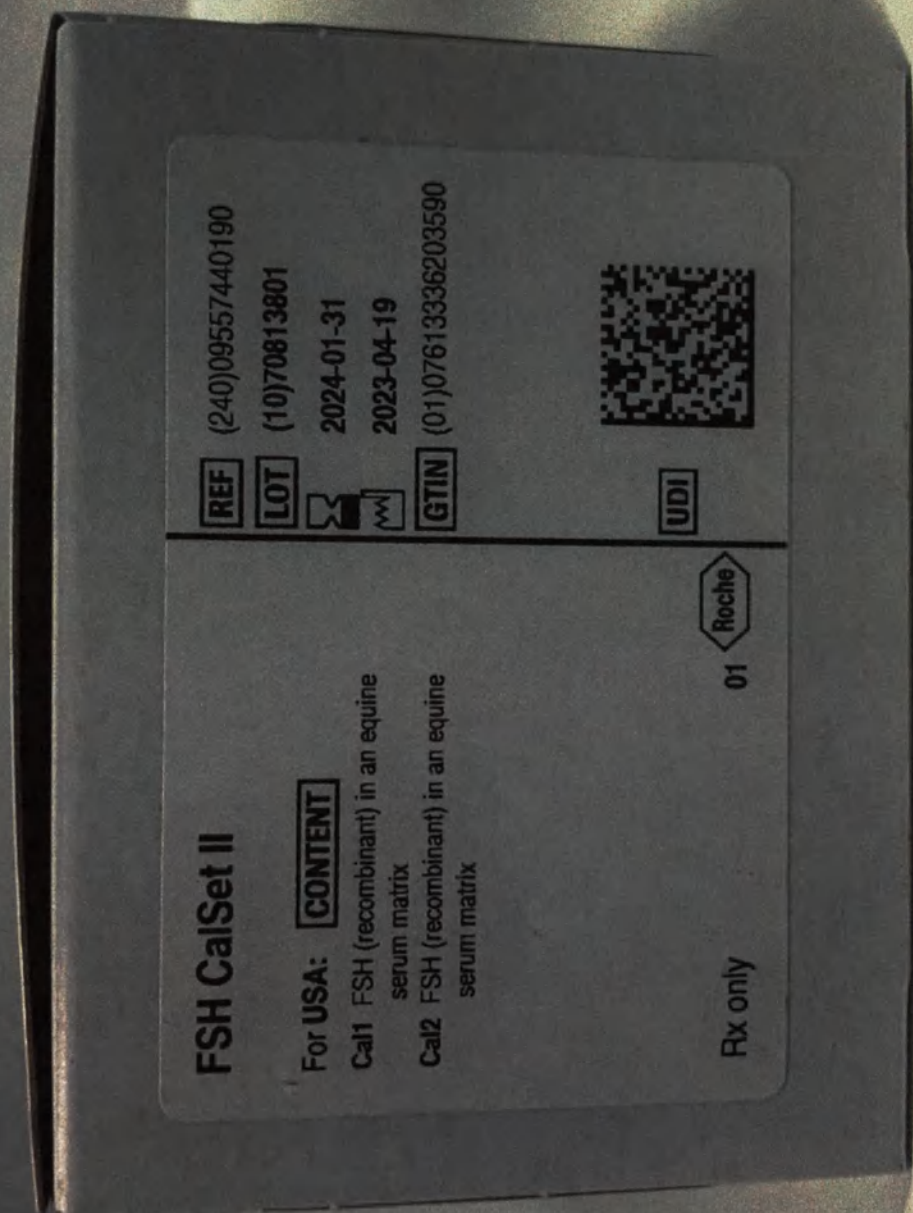

Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers)



Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers)

Набор калибраторов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (FSH CalSet II cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (FSH Cal1), флакон, объем 1 мл - 2 шт.
2. Калибратор 2 (FSH Cal2), флакон, объем 1 мл - 2 шт.
3. Флакон пустой - 4 шт.
4. Карта со штрих-кодом
5. Этикетка со штрих-кодом для флаконов - 12 шт.
6. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9407 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Назначение: предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-09-99, факс: +7 495 229-02-64. E-mail: plasmom_calibration2_dia@roche.com

Кат. номер: 09557440190


Калибратор 1 (FSH Cal1), флакон, объем 1 мл - 2 шт.



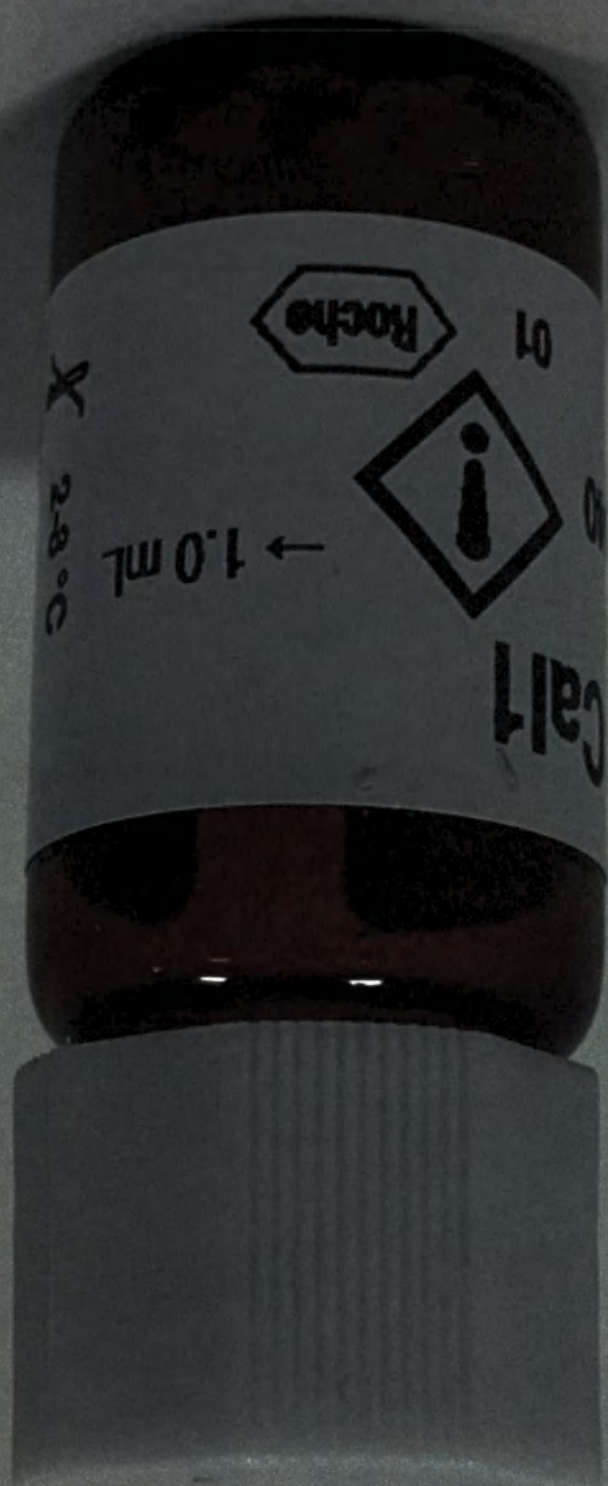


либратор 2 (FSH Cal2), флакон, объем 1 мл - 2 шт.



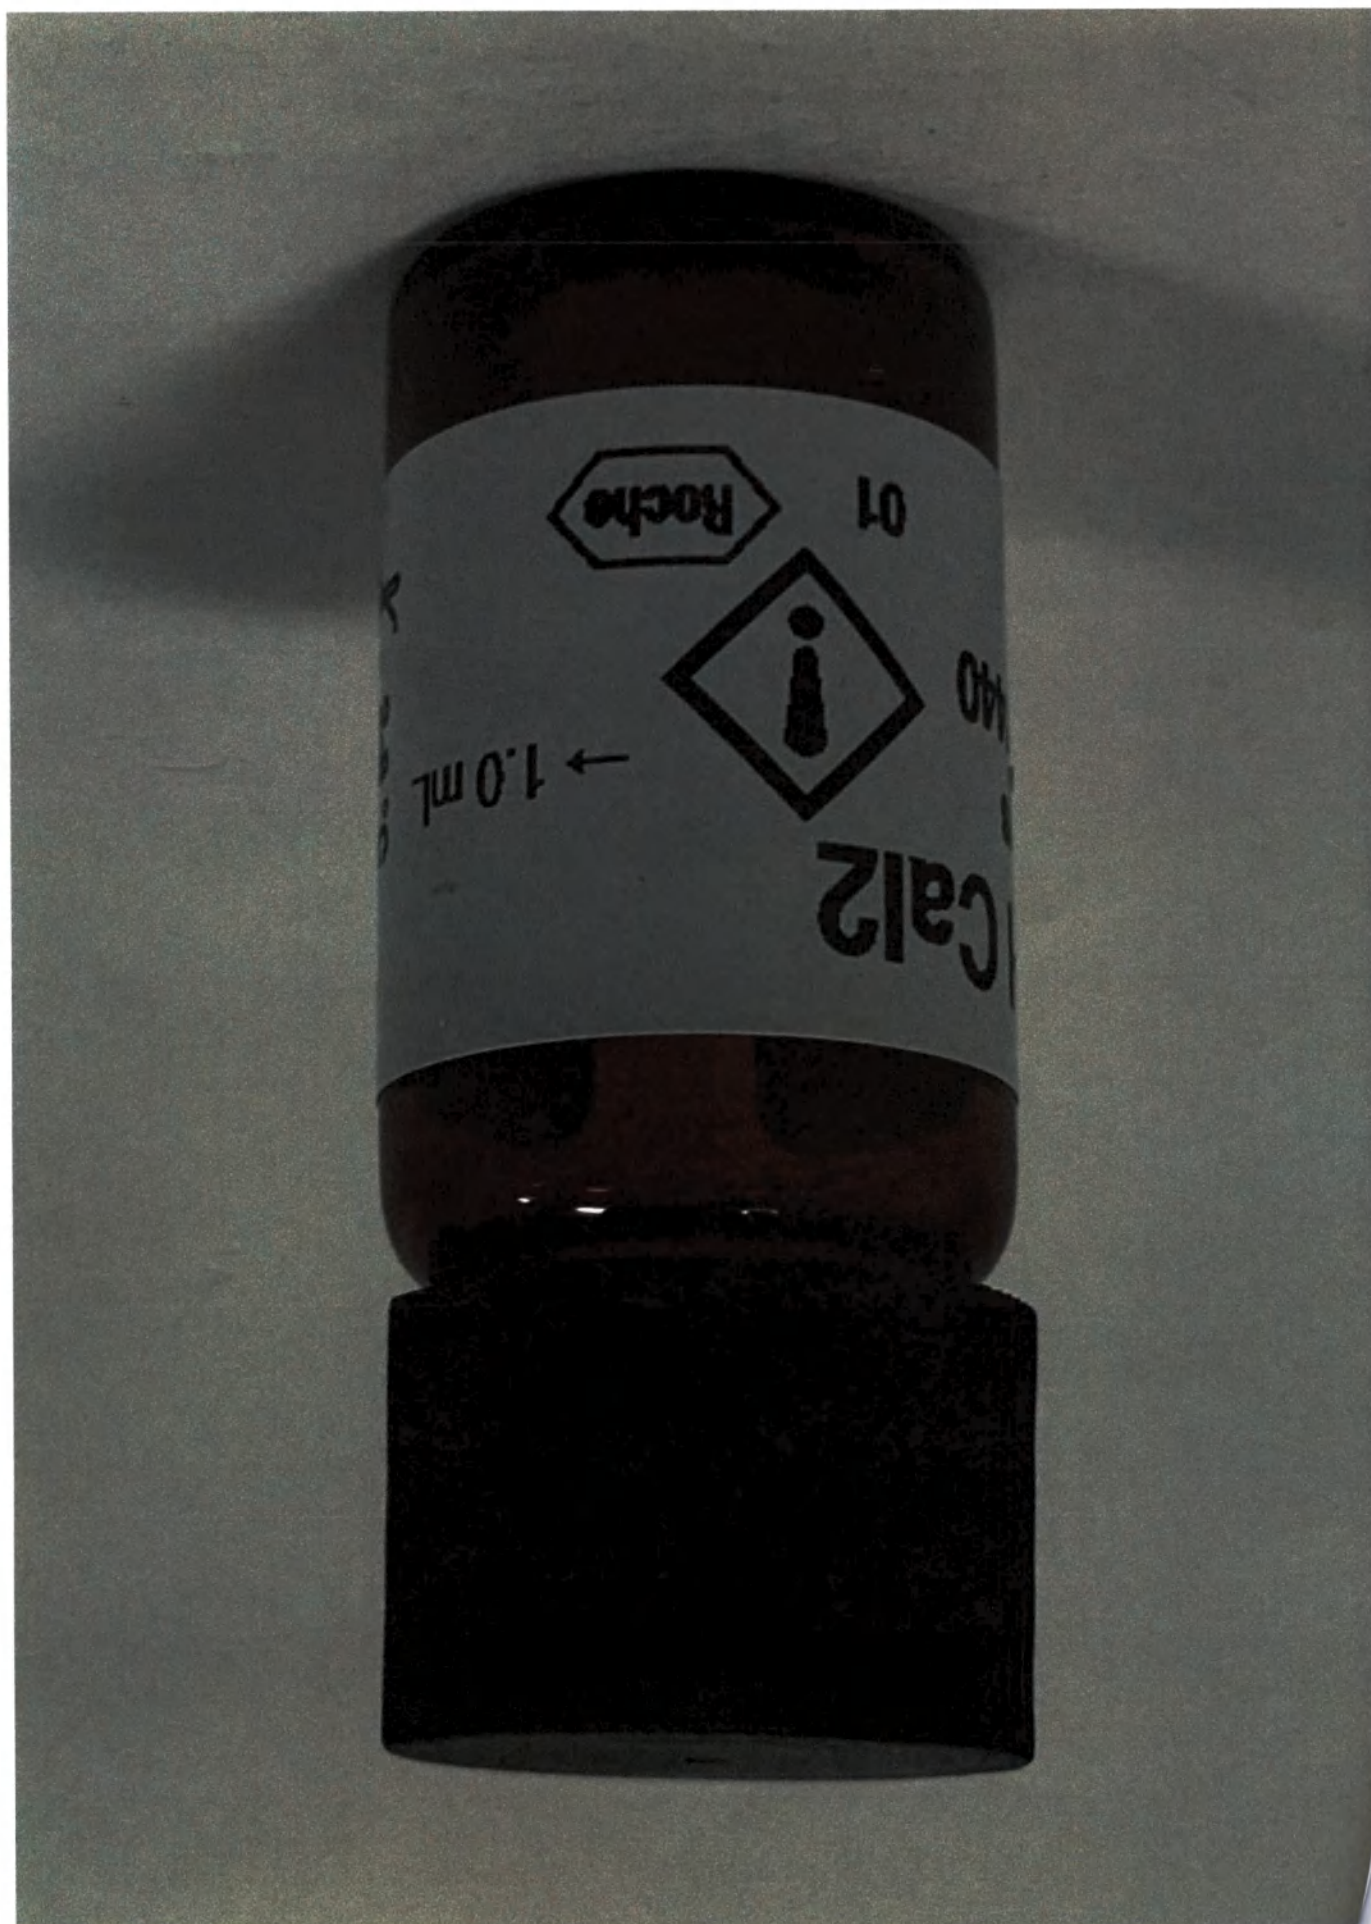

кон пустой - 4 шт.

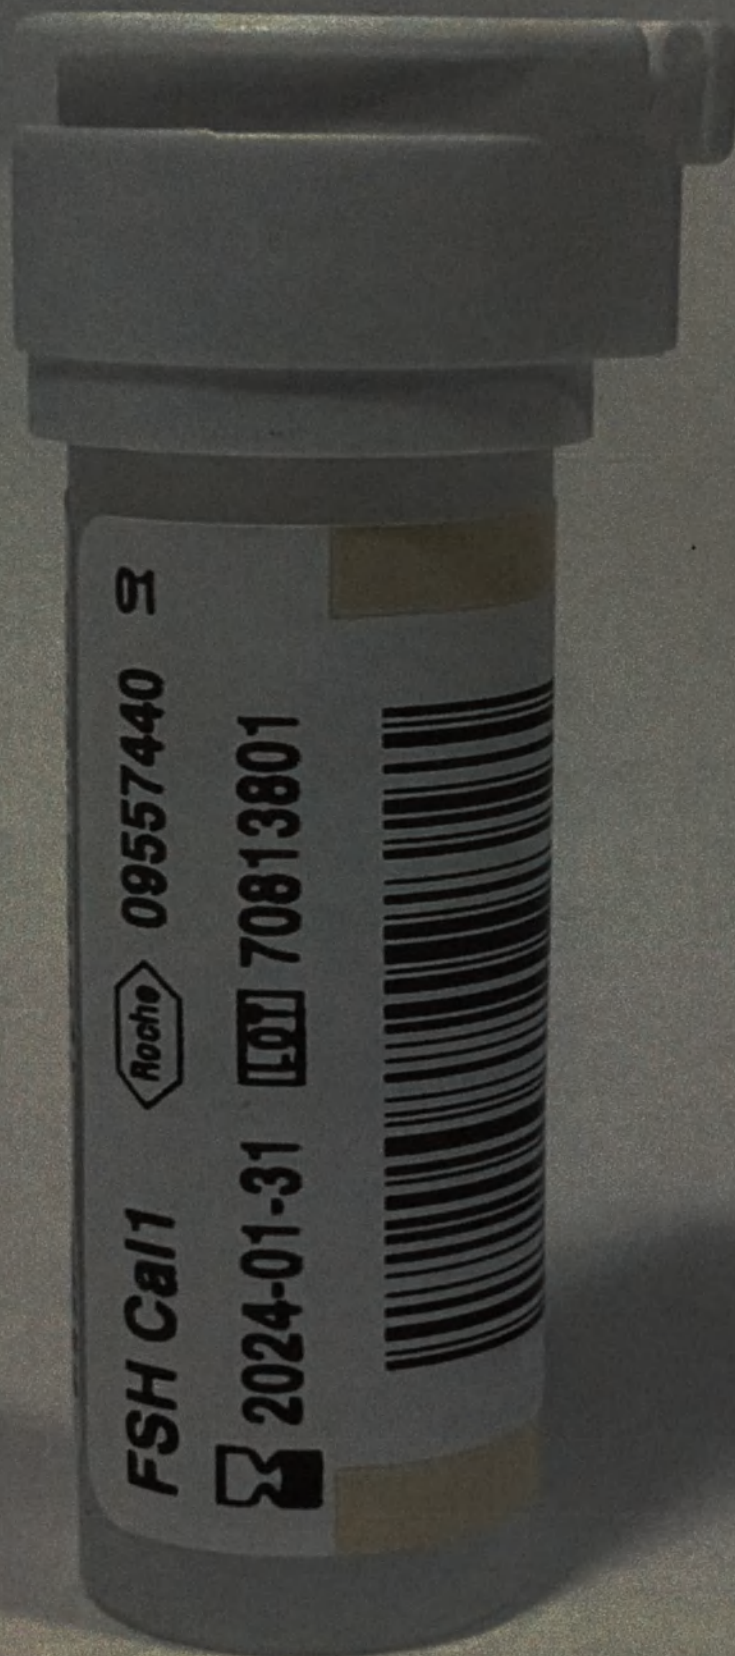




FSH CalSet II

cobas e analyzers


09557440

2350

LOT 708138



01

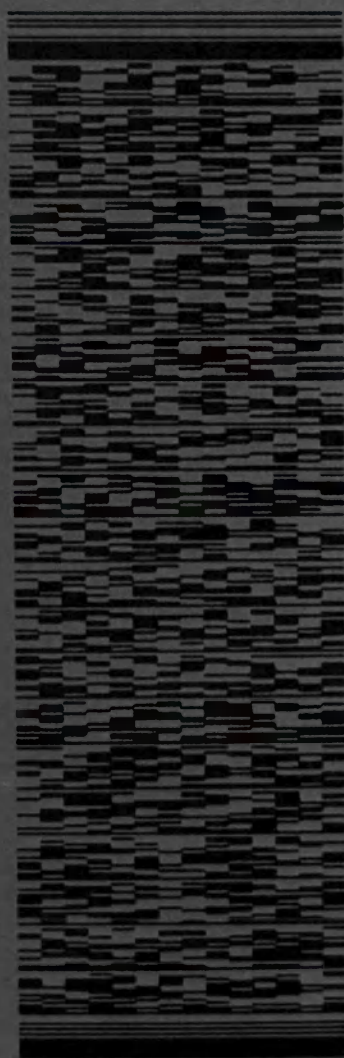

FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal2  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Cal1  09557440 
 2024-01-31  70813801



FSH Caiset II

Считайте для сравнения инструкции

В первой части этой инструкции указаны код продукта и версия документа.

Чтобы скачать этот документ, перейдите по ссылке [dlaogz.roda.com](#).

На веб-сайте вы найдете либо данную версию, либо, по возможности, самую последнюю версию документа, относящуюся к изделию, продукту. Если у вас нет доступа в интернет, обратитесь к ближайшему партнерскому контакту Roda и получите бесплатную копию документа.

Роль: Роль и продукт безопасности кода документа.

Предупреждения и уведомления

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

А. во избежание повреждений в vitro, продукт, генеральный медицинский специалист, должный соблюдать все процедуры, связанные с использованием продукта, должен соблюдать следующие правила:

Держать индикаторы в сухом месте.

Избегать попадания влаги на индикаторы.

Утилизировать продукт в соответствии с инструкциями и процедурами лаборатории.

Роль и продукт безопасности кода документа.

II 192 cobas

Українська

Завантаження інструкції

Для професійної діагностики в клініці. Держувачі завантажувальних завантажень, необхідних для користування всією лабораторною технікою.

Інструкції до модулів, модулів.

Програмне забезпечення, пов'язане з діагностикою, а також інформація про продукцію.

Необхідно завантажувати інструкції та програмне забезпечення.

Застосовувати всі відповідні методи правління щодо утилізації для видалення інформації.

Підготувати безпечний продукт, використовуючи відповідні заходи.

Для США: Увага! Формування закон обмежень продаж цього продукту тільки після того, як він буде завантажено.

Цей комплект містить комплект, що відповідає до Регламенту ЕС.

№ 1272/2008, класифікується таким чином.



Увага

Можливо виконати алгоритм швидкої реакції.

Швидко діяти в разі аварії в системі з автоматичним навігатором.

Професіонали:

Уникайте виходу з маршруту.

Уникайте потрапляння до невідомої території.

Результат:

Оглядіть завантажені дані.

Результат:

Результат виконання програми або виходу. Зверніться до менеджера компанії/дистрибутора.

Результат:

Завантаження інструкції

Увага:

Уникайте виходу з маршруту.

Результат:

Можливо виконати алгоритм швидкої реакції.

Швидко діяти в разі аварії в системі з автоматичним навігатором.

Професіонали:

Уникайте виходу з маршруту.

Уникайте потрапляння до невідомої території.

Результат:

Оглядіть завантажені дані.

Результат:

Завантаження інструкції

Увага:

Можливо виконати алгоритм швидкої реакції.

Швидко діяти в разі аварії в системі з автоматичним навігатором.

Професіонали:

Уникайте виходу з маршруту.

Уникайте потрапляння до невідомої території.

Результат:

Завантаження інструкції

Увага:

Можливо виконати алгоритм швидкої реакції.

Швидко діяти в разі аварії в системі з автоматичним навігатором.

Професіонали:

Уникайте виходу з маршруту.

Уникайте потрапляння до невідомої території.

Результат:

Завантаження інструкції

Увага:

Можливо виконати алгоритм швидкої реакції.

Швидко діяти в разі аварії в системі з автоматичним навігатором.

Професіонали:

Уникайте виходу з маршруту.

Уникайте потрапляння до невідомої території.

Результат:

Завантаження інструкції

кодів в англійській

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью



Мещеряков А.С.

по доверенности
от 30.01.2023 г.