

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
2025 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ЛизисФлоу», по ТУ 21.20.23-643-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

Кат. № 300-53-01

На пачку:

ЛизисФлоу
Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ЛизисФлоу», по ТУ 21.20.23-643-98539446-2023

LOT E003	 2023-04-12
REF 300-53-01	 2024-04-12
IVD	 300

 25°C   

Комплект поставки:

1. ЛизисФлоу А	1 фл. (220 мл)
2. ЛизисФлоу В	1 фл. (100 мл)
3. ЛизисФлоу С	1 фл. (40 мл)
4. Инструкция	1 шт.
5. Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-643-98539446-2023
РУ №

ЛизисФлоу

2 000027 789535

 2024-04-12

LOT E003

ТУ 21.20.23-643-98539446-2023
РУ №
Для профессионального применения
V003 F1

На флаконы:

ЛизисФлоу А
REF 300-53-01

объем 220 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

  **IVD**

V003

ЛизисФлоу В
REF 300-53-01

объем 100 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

  **IVD**

V003

ЛизисФлоу С
REF 300-53-01

объем 40 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

  **IVD**

V003

Вариант исполнения 2

Кат. № 300-53

На пачку:

ЛизисФлоу
Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической крови
«ЛизисФлоу», по ТУ 21.20.23-643-98539446-2023

LOT E003	2023-04-12
REF 300-53	2024-04-12
IVD	300

25°C

ТУ 21.20.23-643-98539446-2023
РУ

Комплект поставки:

1. ЛизисФлоу А	2 фл. (по 110 мл)
2. ЛизисФлоу В	1 фл. (100 мл)
3. ЛизисФлоу С	1 фл. (40 мл)
4. Инструкция	1 шт.
5. Паспорт	1 шт.



ЛизисФлоу

2024-04-12
 E003
LOT
ТУ 21.20.23-643-98539446-2023
РУ
Для профессионального применения
V003 F1

На флаконы:

ЛизисФлоу А
REF 300-53

объем 110 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

-2 шт.

ЛизисФлоу В
REF 300-53

объем 100 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

ЛизисФлоу С
REF 300-53

объем 40 мл
серия № E003
годен до 2024-04-12
готов к использованию
хранить при +2...+25°C

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТШ) лист А

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
28.04.2024 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для лизиса эритроцитов цельной периферической
крови «ЛизисФлоу», по ТУ 21.20.23-643-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**


УПРАВЛЕНИЕ
по санитарно-эпидемиологическому надзору
в Чувашской Республике
г. Чебоксары, ул. Т. 21, 20-23-443 00039446-2023

ООО «Сирми»
г. Чебоксары, ул. Т. 21, 20-23-443 00039446-2023
ИНН 21-08-00111
ОГРН 1022101000000

Исходные данные
Исходные данные
Исходные данные

1. Введение
2. Описание
3. Заключение
4. Рекомендации
5. Приложение

Наименование	Единица измерения	Количество	Срок годности	Срок хранения
Исходные данные	шт.	1	1 год	1 год
Исходные данные	шт.	1	1 год	1 год
Исходные данные	шт.	1	1 год	1 год
Исходные данные	шт.	1	1 год	1 год
Исходные данные	шт.	1	1 год	1 год

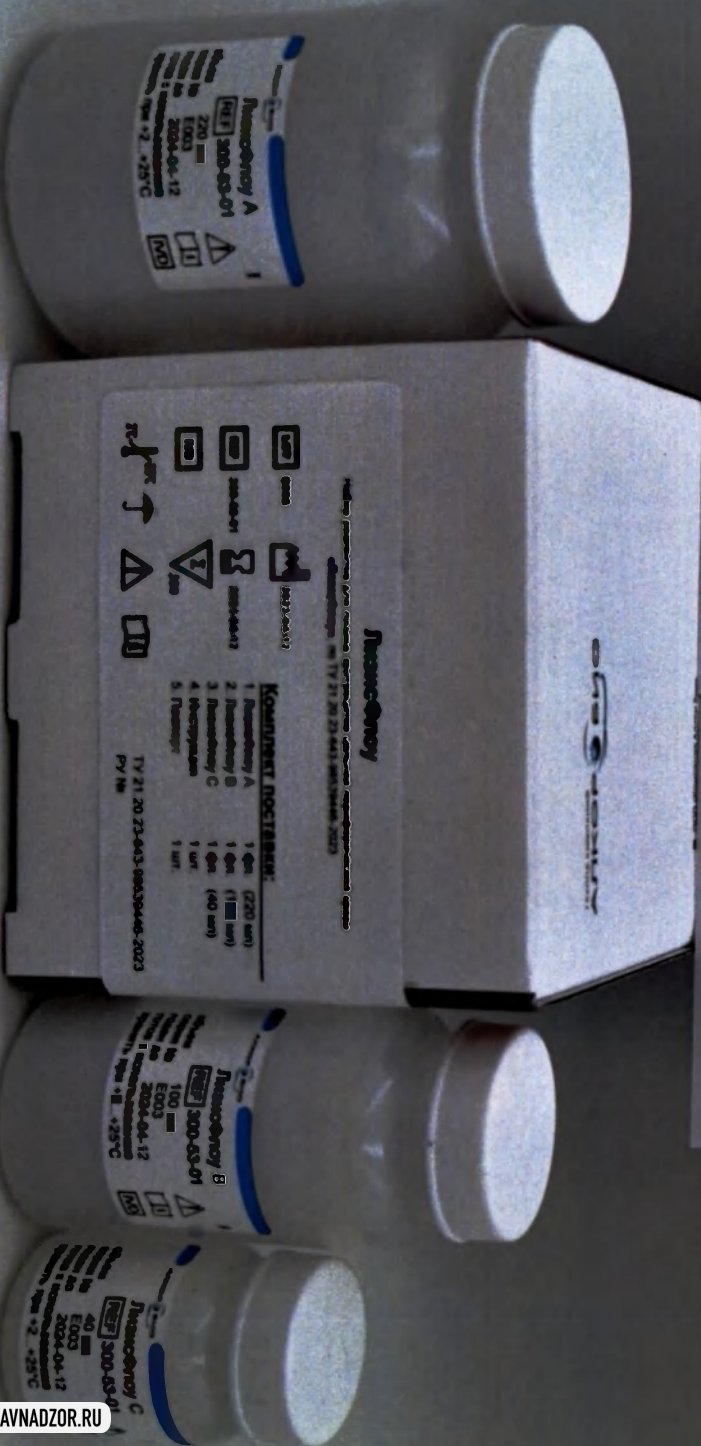

ИСТОВНИК

Государственный адрес
ООО «Алкор Био»
Почтовый адрес
2000

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по применению для медицинских работников

Набор реактивов для определения активности ферментов крови

«Алкор Био» ТУ 21.20.23-643-98539446-2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ





1.1. Набор реактивов для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) предназначен для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) в клинической практике.

1.2. Набор реактивов для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) предназначен для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) в клинической практике.

1.3. Набор реактивов для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) предназначен для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) в клинической практике.

1.4. Набор реактивов для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) предназначен для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) в клинической практике.

1.5. Набор реактивов для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) предназначен для определения активности ферментов крови (Алкор Био ТУ 21.20.23-643-98539446-2023) в клинической практике.

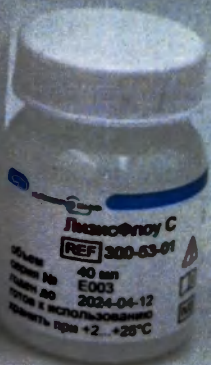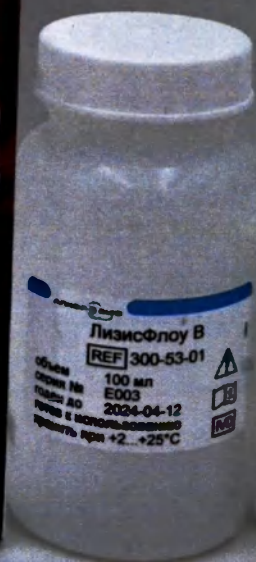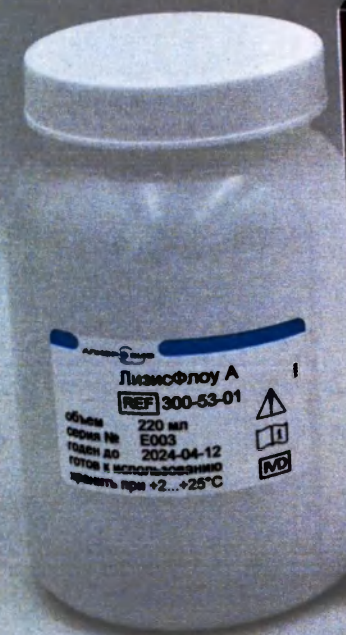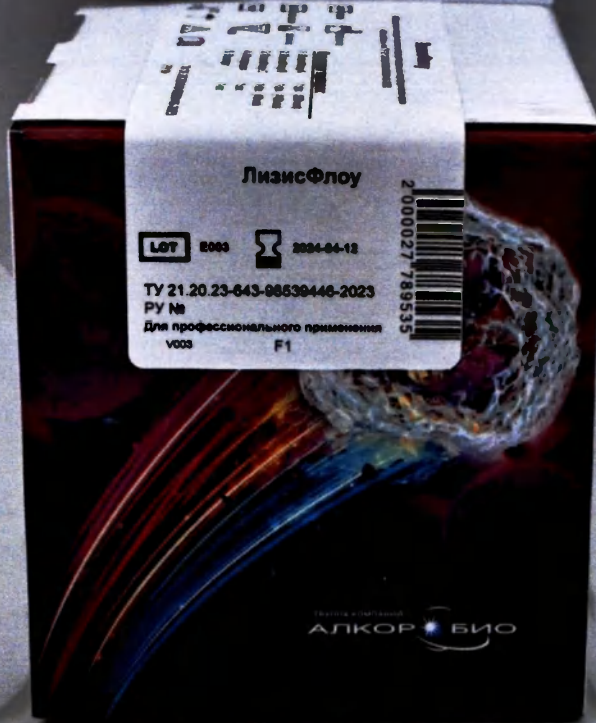

ООО «Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Ушаковского пр., д. 46, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-57-79

ПАСПОРТ № E003




Набор реактивов для определения активности ферментов крови





Иск. № 200-53-01, Серия № E003, Формулярный № 1, Количество 180 шт.

Наименование	Составляющие компоненты	Единица измерения	Вид	Состояние
ЛизисФлоу А	Составляющие компоненты, входящие в комплект	1 шт.	Вид	Состояние
ЛизисФлоу В	Составляющие компоненты, входящие в комплект	1 шт.	Вид	Состояние
ЛизисФлоу С	Составляющие компоненты, входящие в комплект	1 шт.	Вид	Состояние
Набор	Составляющие компоненты, входящие в комплект	1 шт.	Вид	Состояние

Инструкция по применению

Наименование	Параметры контроля качества	Результат
ЛизисФлоу А	Внешний вид	Состояние
ЛизисФлоу В	Внешний вид	Состояние
ЛизисФлоу С	Внешний вид	Состояние
Набор	Внешний вид	Состояние

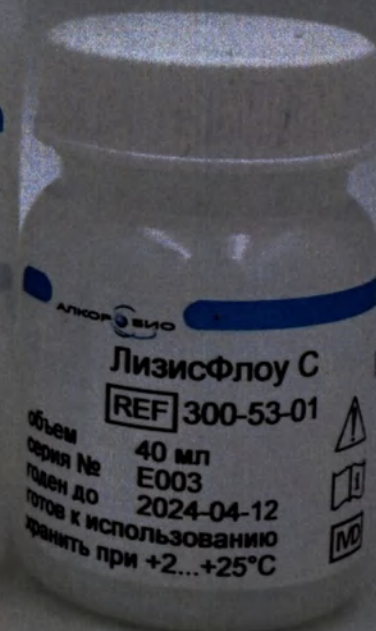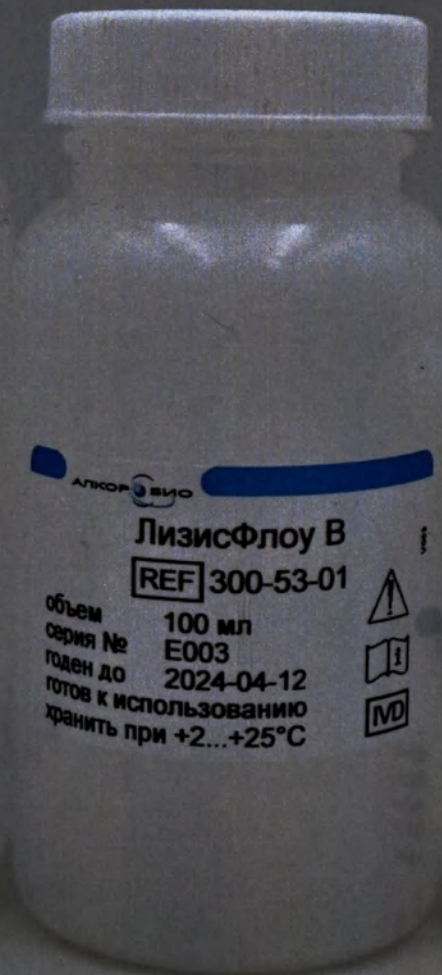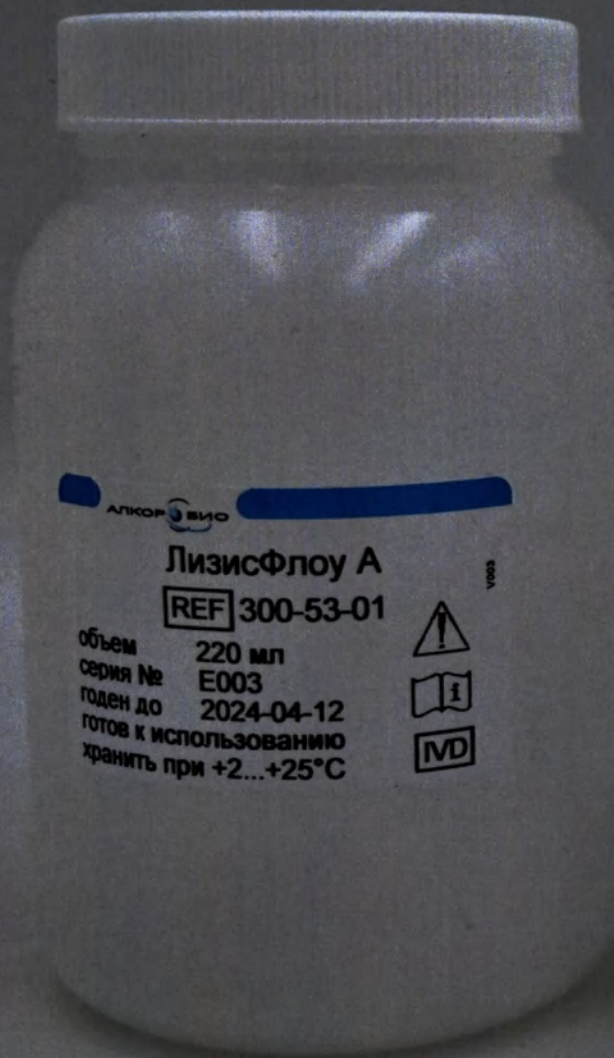

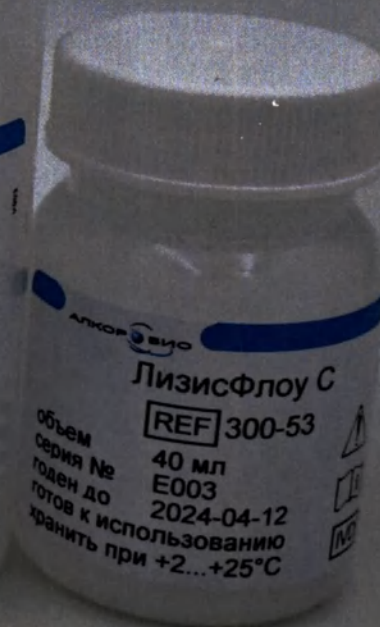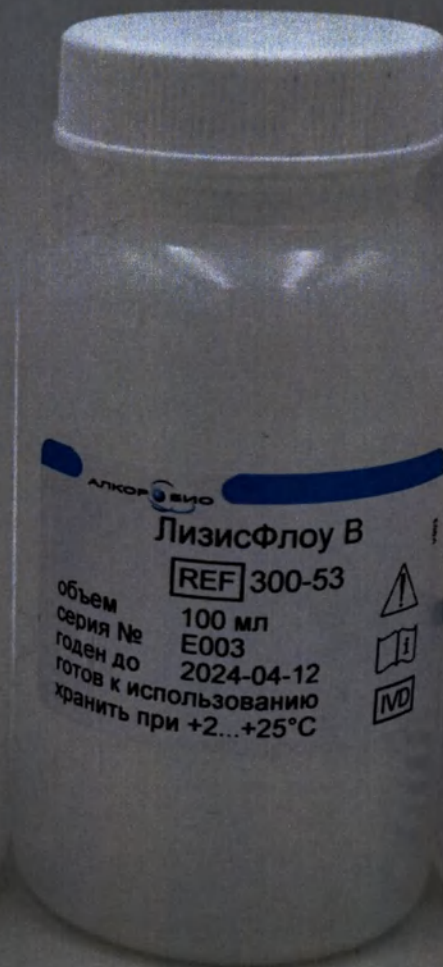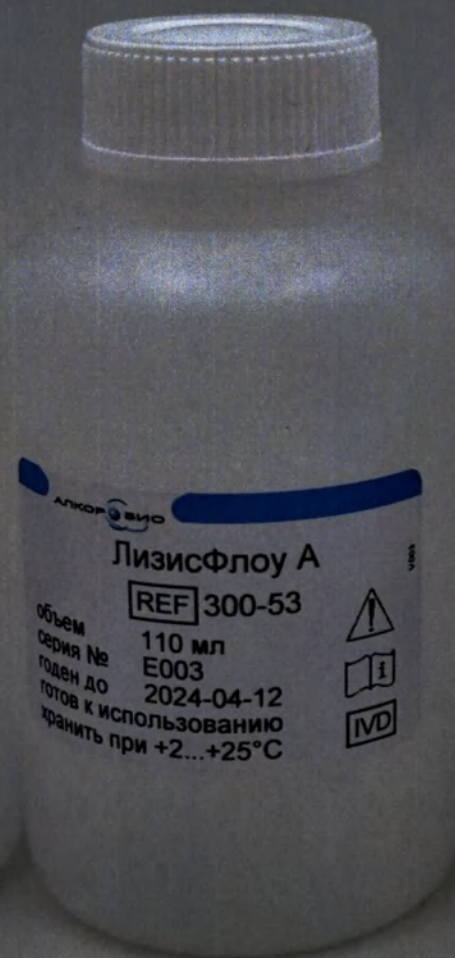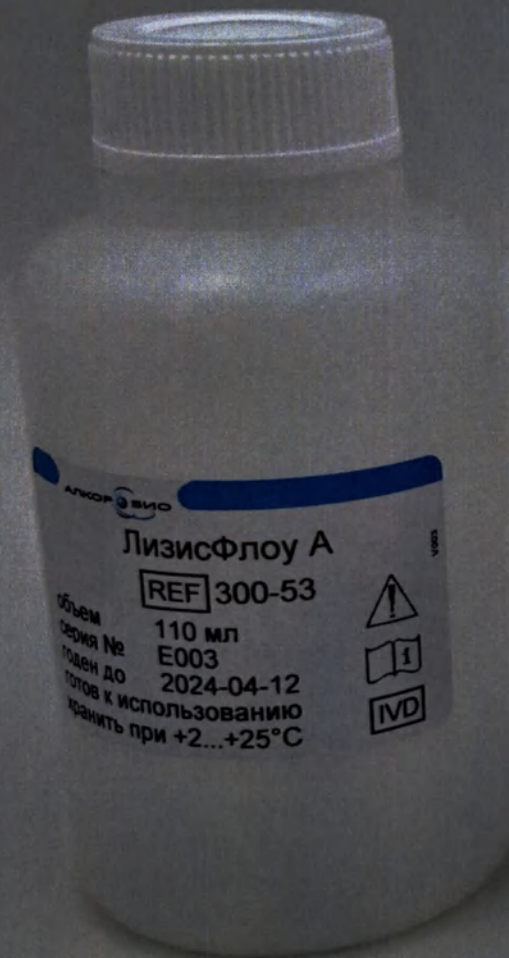

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

7 (2016) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

