

ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий – индивидуальный
предприниматель ООО «БИ Плюс»

В.Ф. Потака

«5» марта 2024 г.



МАКЕТ УПАКОВКИ
медицинского изделия

Ретракторы стоматологические одноразовые
DENTAL FORMULA

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023

г. Санкт-Петербург


Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №1:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: Kids, цвет: белый.

Маркировка индивидуальной упаковки:



Маркировка групповой упаковки:

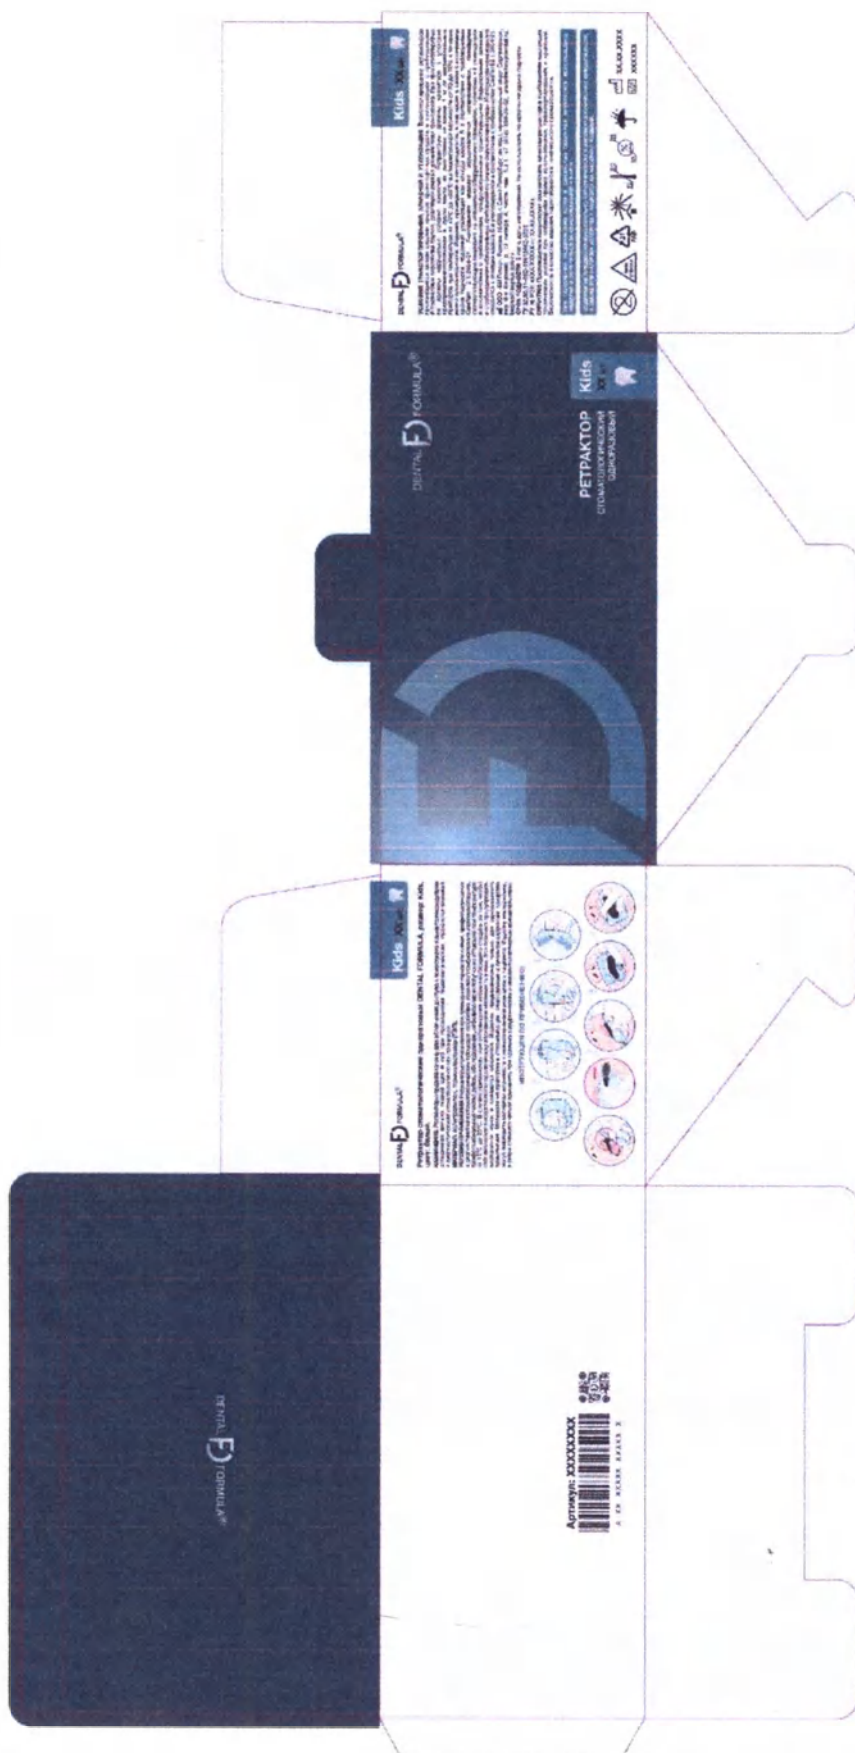




Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: Kids, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством отсечения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

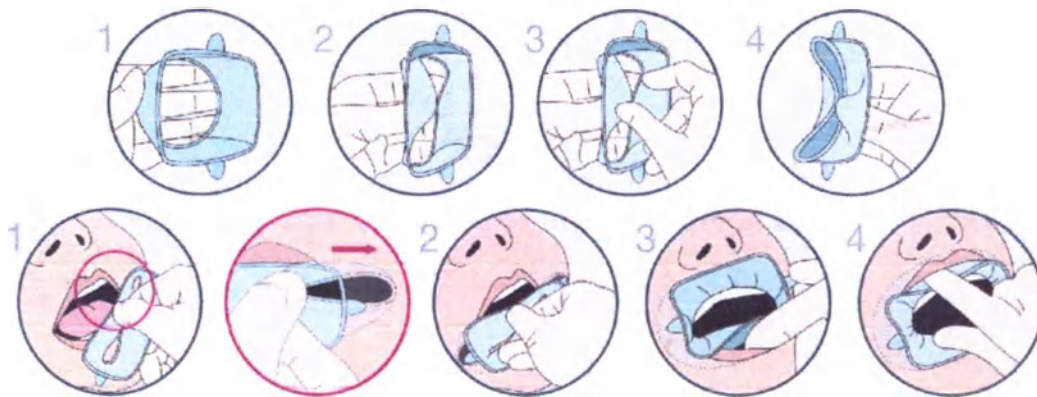

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ: Транспортирование ретракторов производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Ретракторы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности от 30 до 70% в течение всего срока годности. Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydent.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.


ТУ 32.50.11-002-19812462-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

ГАРАНТИИ: Производитель гарантирует соответствие качества ретракторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВРАЧУ.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОРАЛЬНО-ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ АЛЛЕРГИИ У ПАЦИЕНТА НА МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ.



XX.XX.XXXX



XXXXXX

DENTAL  FORMULA®


Kids XX шт. 

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: Kids, цвет: белый.

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydental.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.



Артикул: XXXXXXXX

 XX.XX.XXXX

 XXXXXX


X XX XXXXX XXXXX X


Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №2:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S, цвет: белый.

Маркировка индивидуальной упаковки:



Маркировка групповой упаковки:

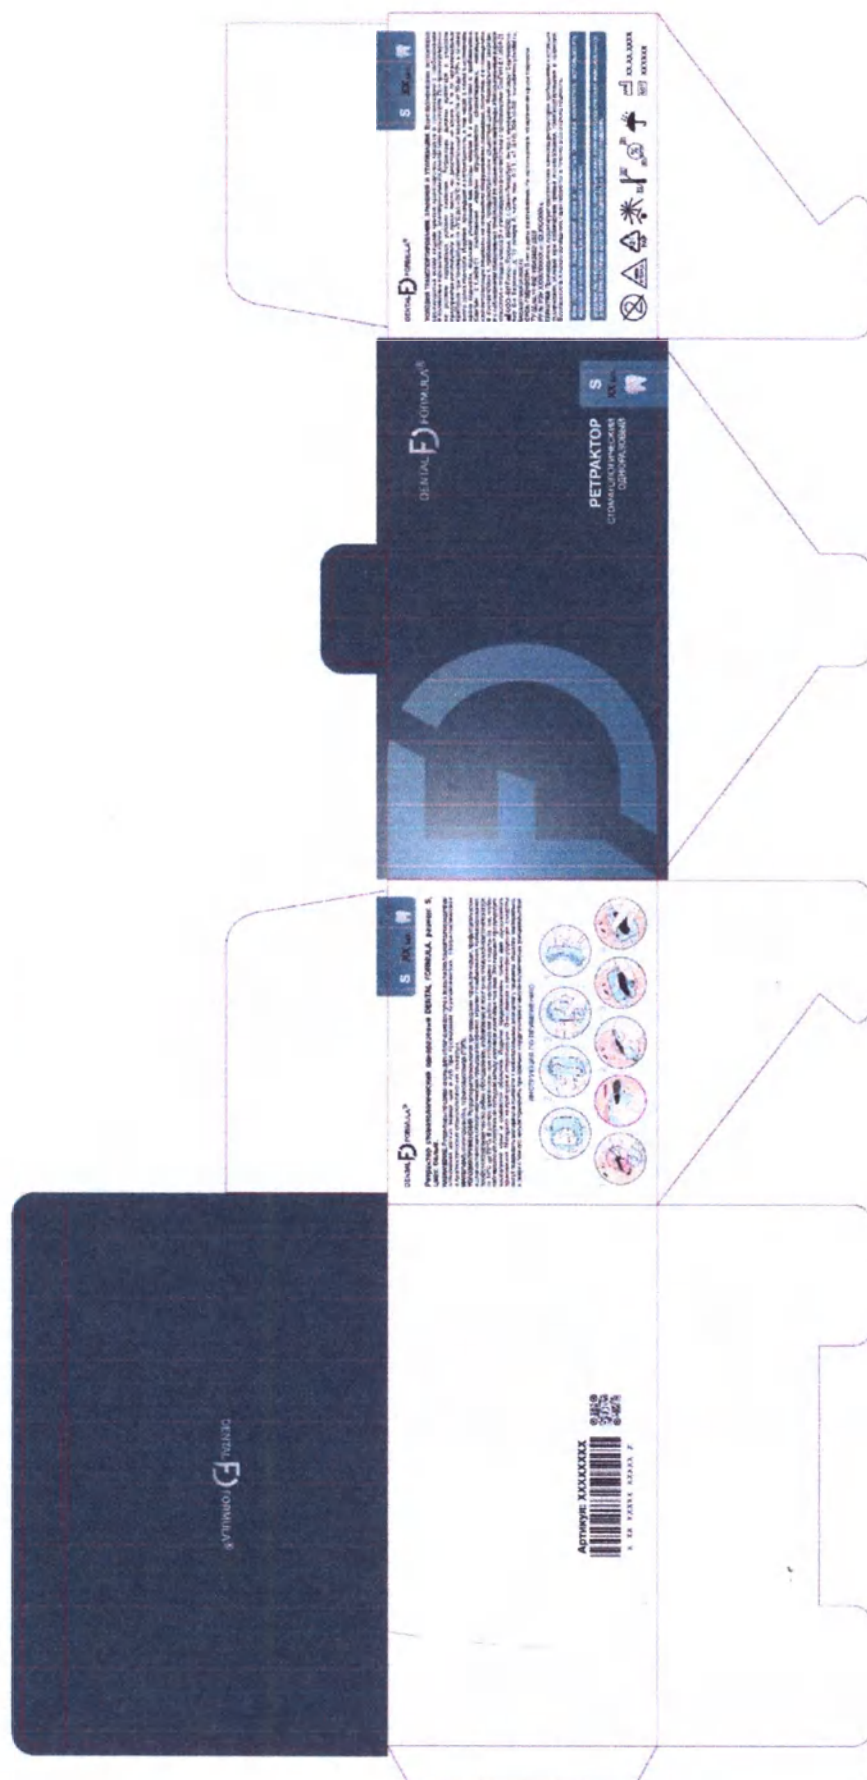




Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством отсечения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

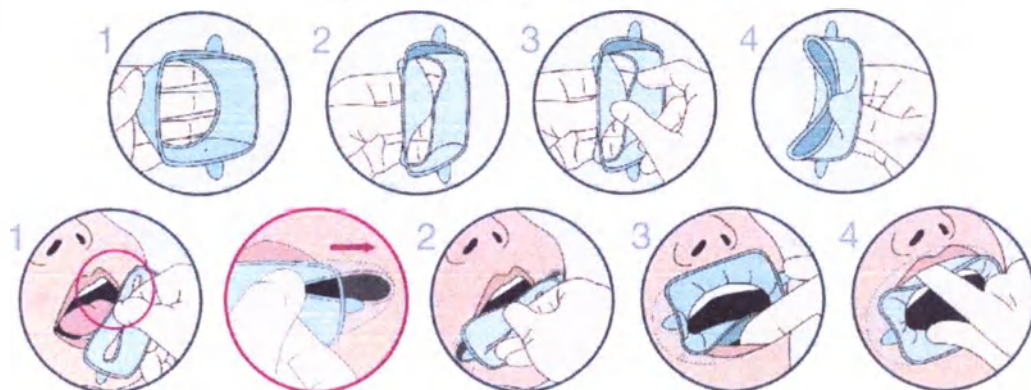

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ: Транспортирование ретракторов производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Ретракторы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности от 30 до 70% в течение всего срока годности. Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydental.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.




ТУ 32.50.11-002-19812462-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

ГАРАНТИИ: Производитель гарантирует соответствие качества ретракторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВРАЧУ.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОРАЛЬНО-ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ АЛЛЕРГИИ У ПАЦИЕНТА НА МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ.



XX.XX.XXXX



XXXXXX

DENTAL  FORMULA®



S XX шт. 

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S, цвет: белый.

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydental.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.



Артикул: XXXXXXXX



 XX.XX.XXXX


 XXXXXX

X XX XXXXX XXXXX X


Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №3:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: М, цвет: белый.

Маркировка индивидуальной упаковки:

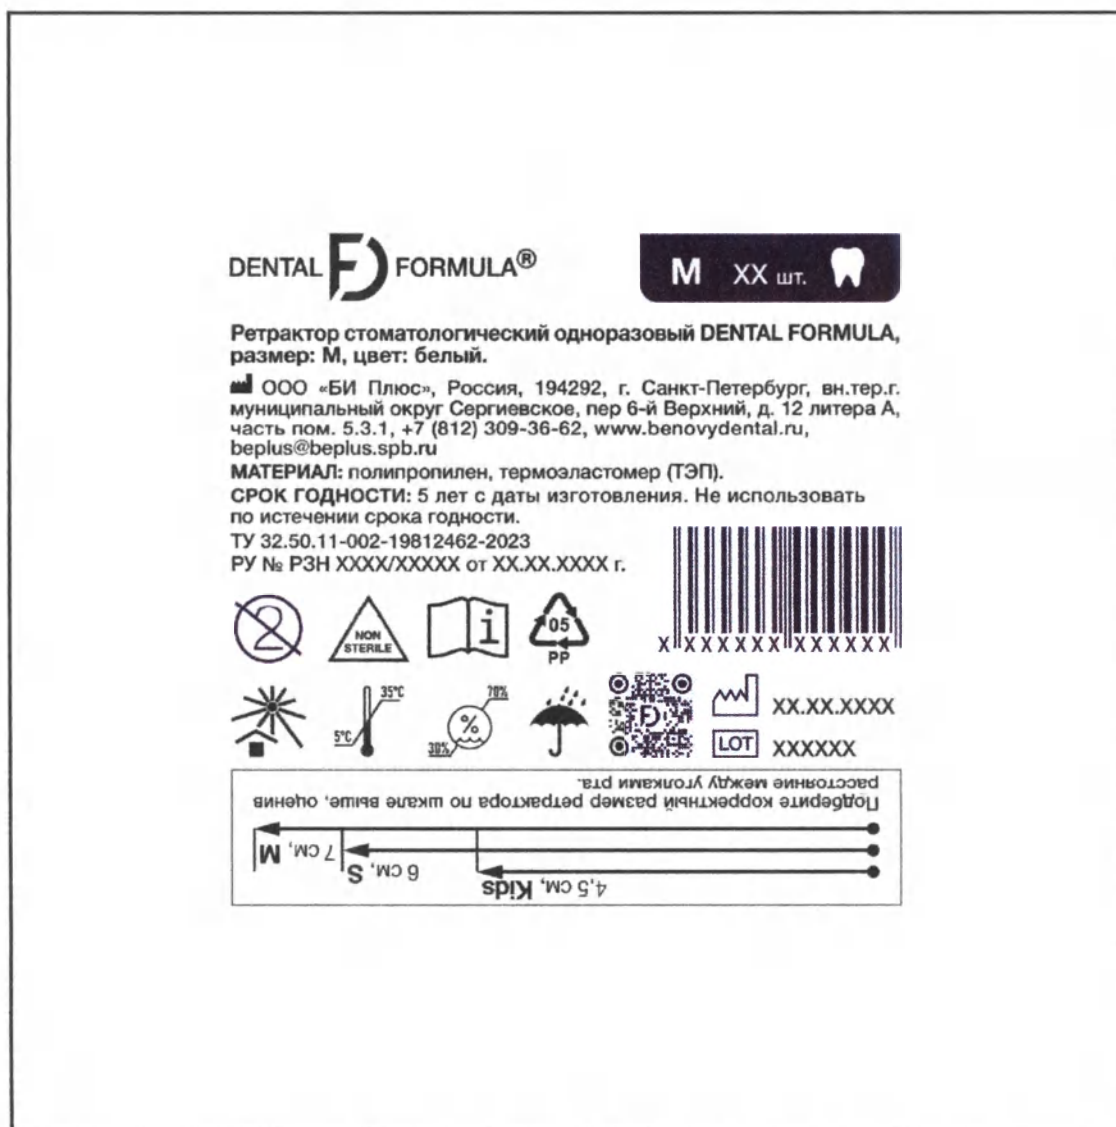

Маркировка групповой упаковки:

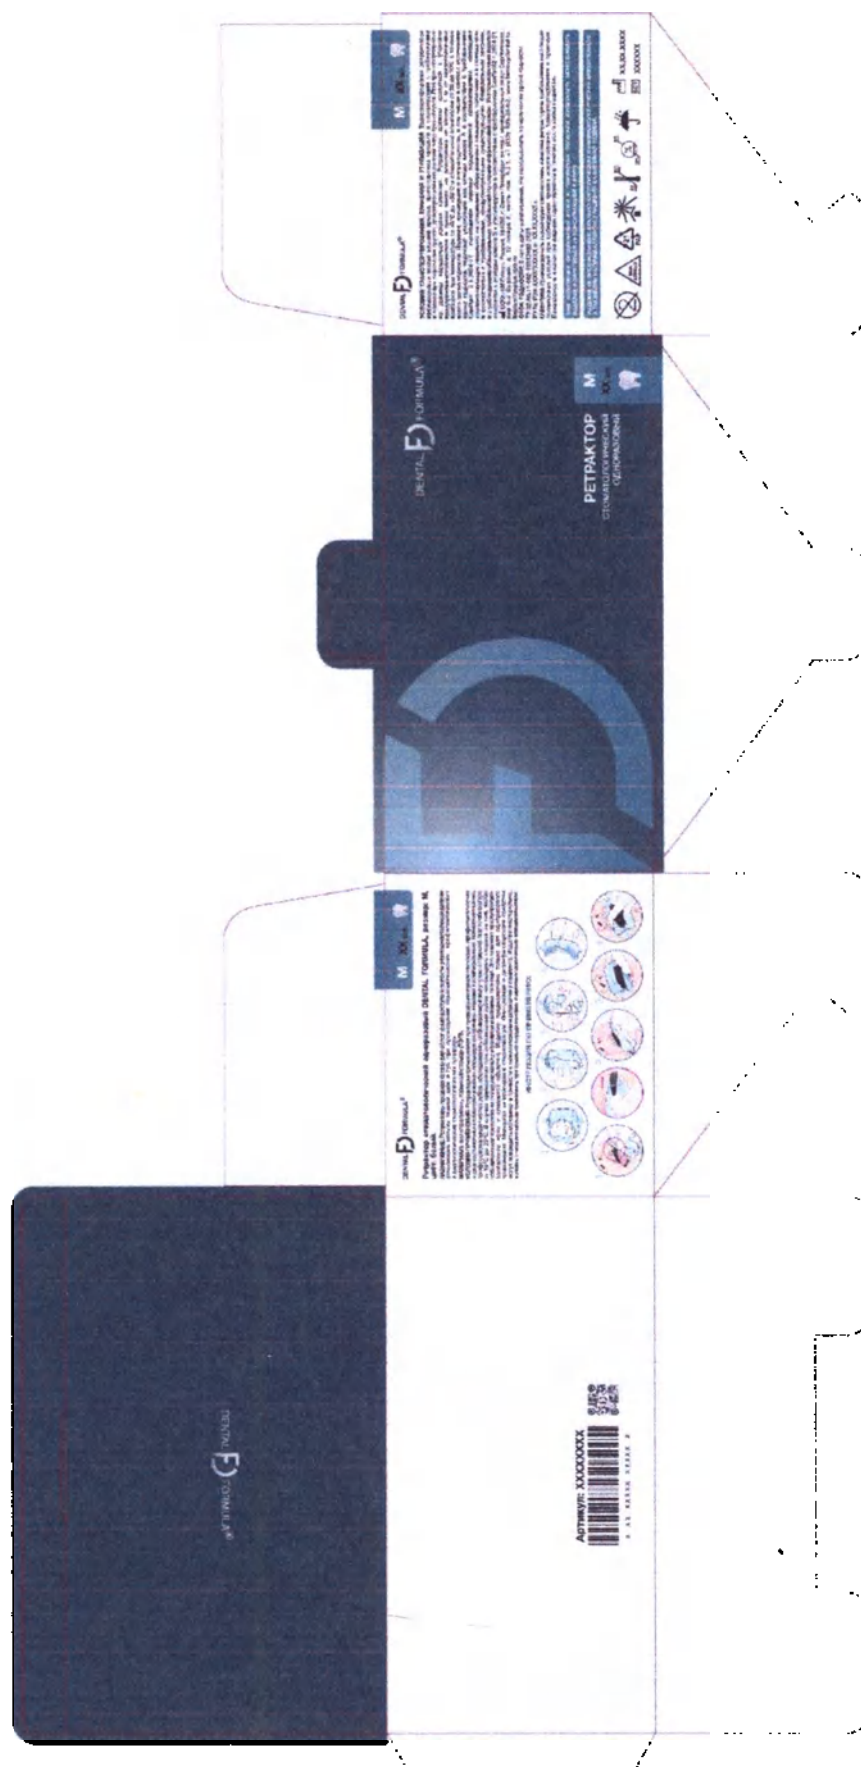




Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: M, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством оттеснения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

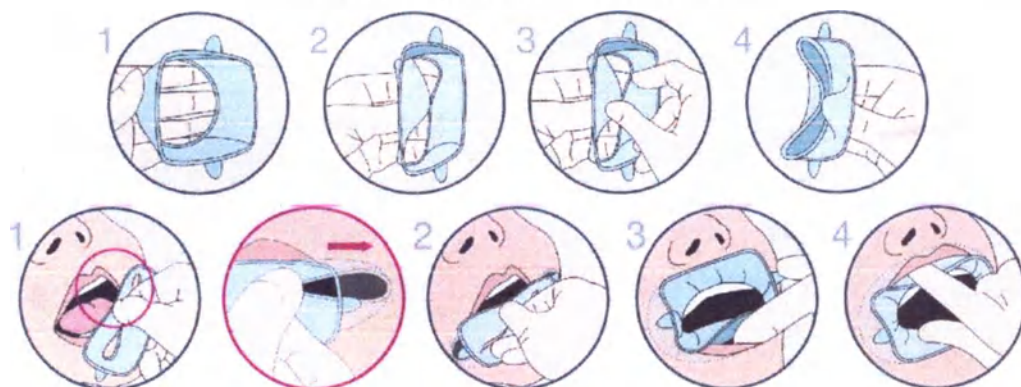


Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: M, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством оттеснения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

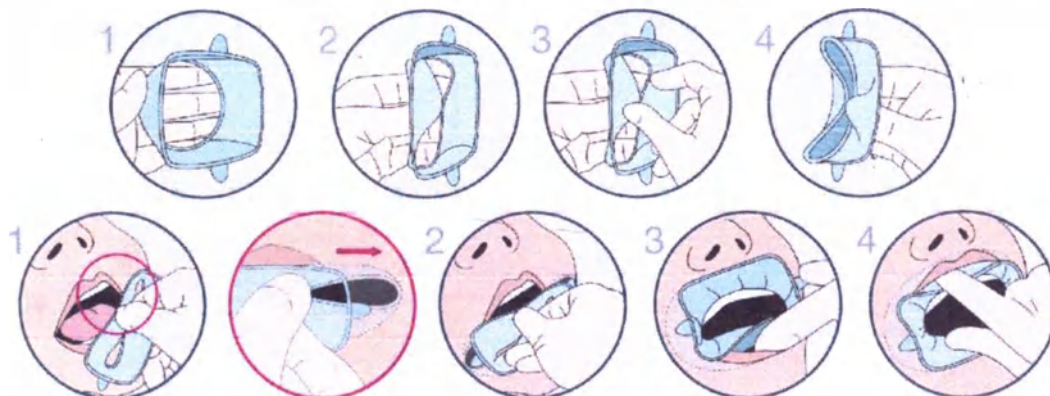

Маркировка транспортной упаковки:

DENTAL  FORMULA®



M XX шт. 

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: М, цвет: белый.

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydental.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023
РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.



Артикул: XXXXXXXX



 XX.XX.XXXX

 XXXXXX


X XX XXXXX XXXXX X

Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №4:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S+M, цвет: белый.

Маркировка индивидуальной упаковки: см. Вариант исполнения №2 и №3

Маркировка групповой упаковки:

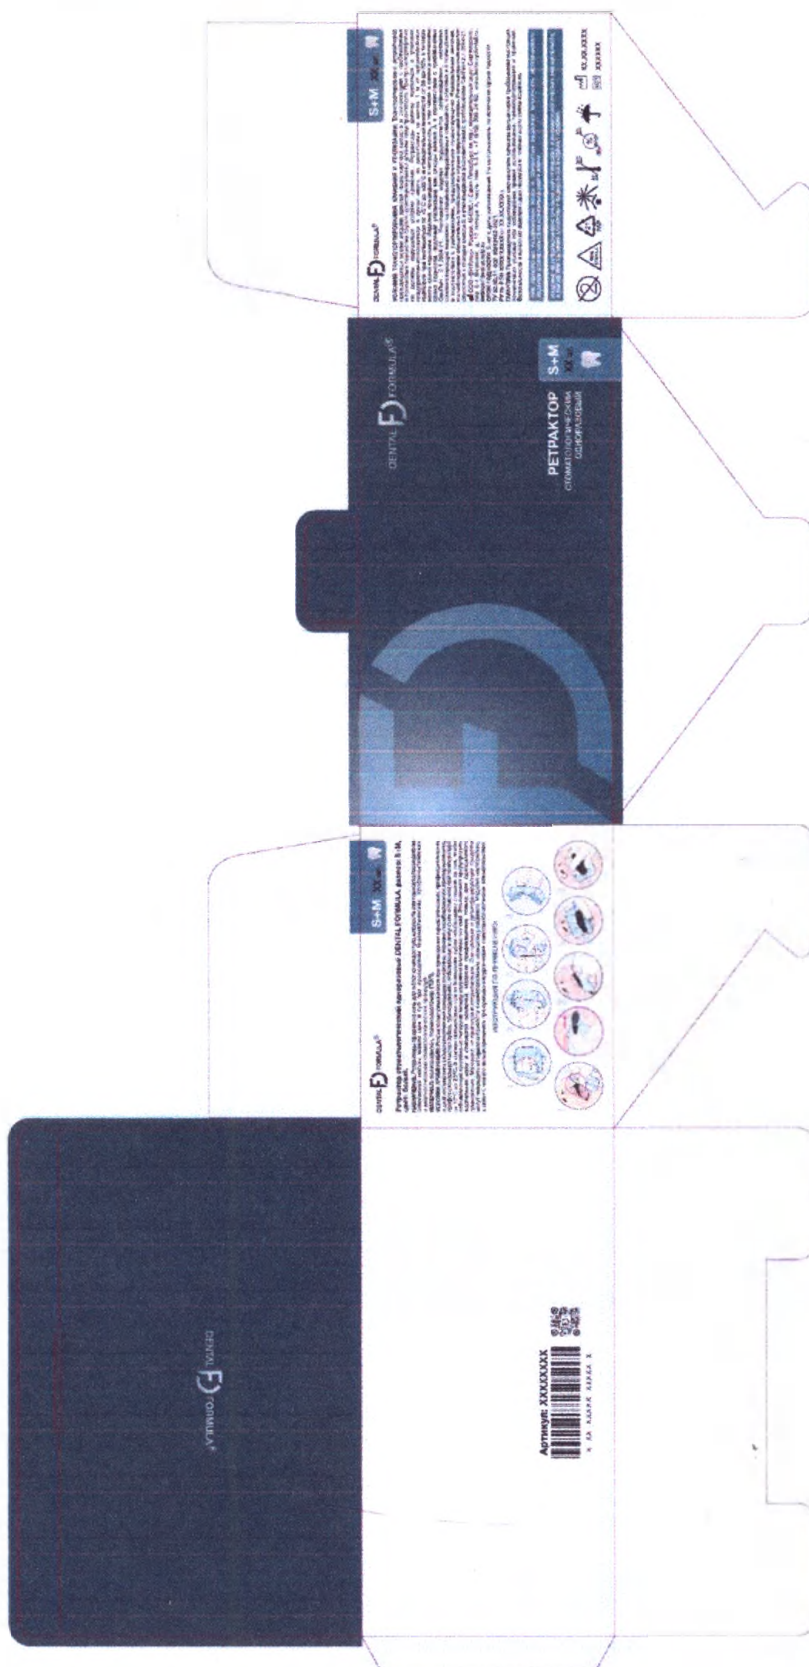




Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S+M, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством отсечения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

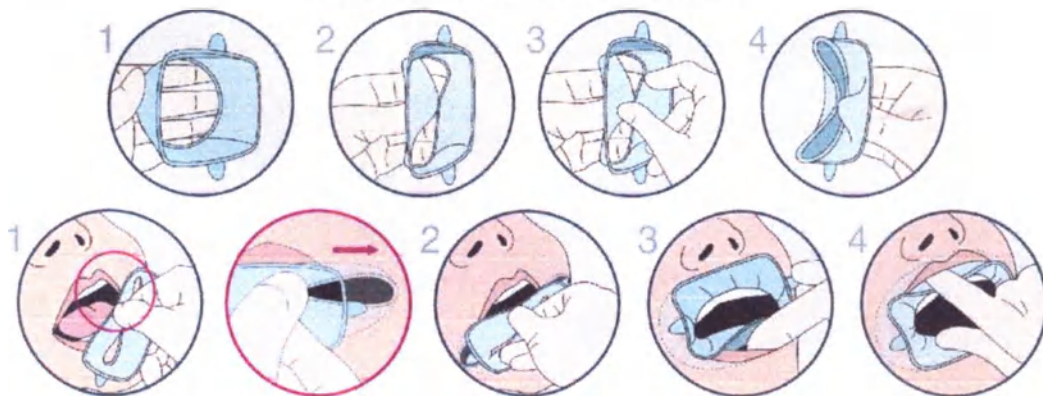


Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S+M, цвет: белый.

НАЗНАЧЕНИЕ: Ретракторы предназначены для облегчения доступа к полости рта пациента посредством отсечения мягких тканей щек и губ при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур.

МАТЕРИАЛ: полипропилен, термоэластомер (ТЭП).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Ретракторы применяются при проведении терапевтических, профилактических и диагностических стоматологических процедур (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание и получение оттисков) при температуре от 15°C до 25°C. В случае применения при отбеливании зубов необходимо следить за тем, чтобы отбеливающее средство не попадало между изделием и мягкими тканями. Это поможет предупредить воспаление кожи и слизистой оболочки. Изделие предназначено только для одноразового применения. Материал не пригоден к стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут повредить материал и привести к нежелательным реакциям у пациента. Изделие нестерильно, в связи с чем его нельзя применять при орально-хирургических и имплантологических вмешательствах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

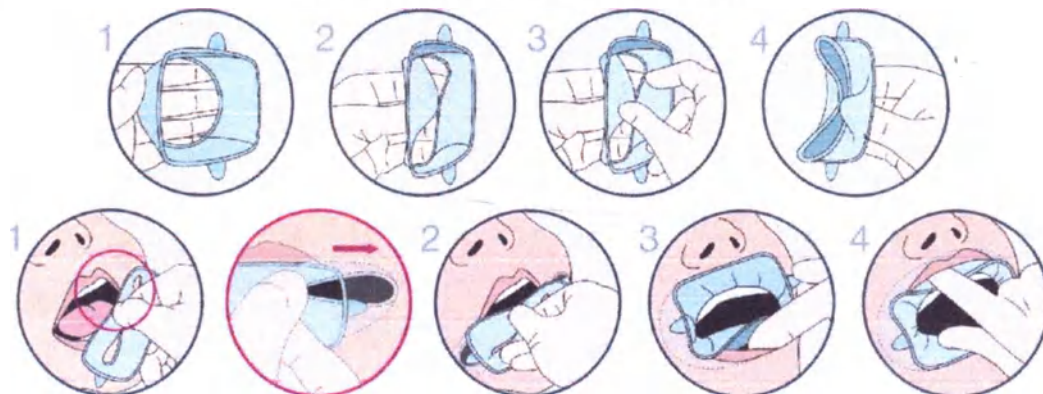

Маркировка транспортной упаковки:

DENTAL  **FORMULA®**



S+M XX шт. 

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S+M, цвет: белый.

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, www.benovydental.ru, beplus@beplus.spb.ru

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.



 XX.XX.XXXX  XXXXXX

Артикул: XXXXXXXX

X XX XXXXX XXXXX X



Всего прошито и скреплено
печатью 16 листа/ов/
управляющий-ИП
ПОТАКА В.Ф.

ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий – индивидуальный
предприниматель ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

«5» марта 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

Ретракторы стоматологические одноразовые
DENTAL FORMULA

ТУ 32.50.11-002-19812462-2023

г. Санкт-Петербург


Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №1:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: Kids, цвет: белый.




Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №2:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S, цвет: белый.

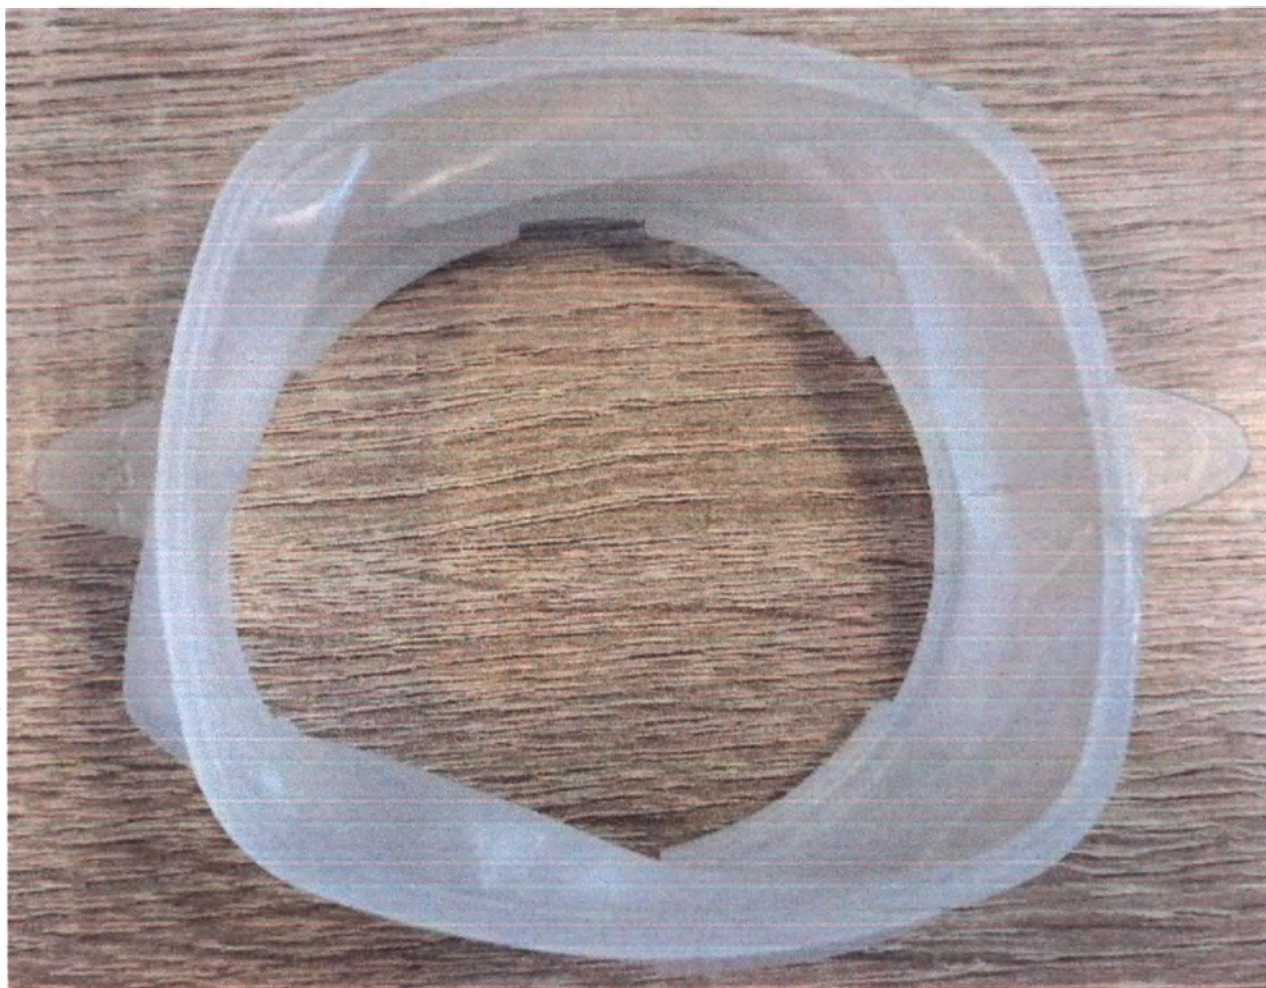


Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №3:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: М, цвет: белый.

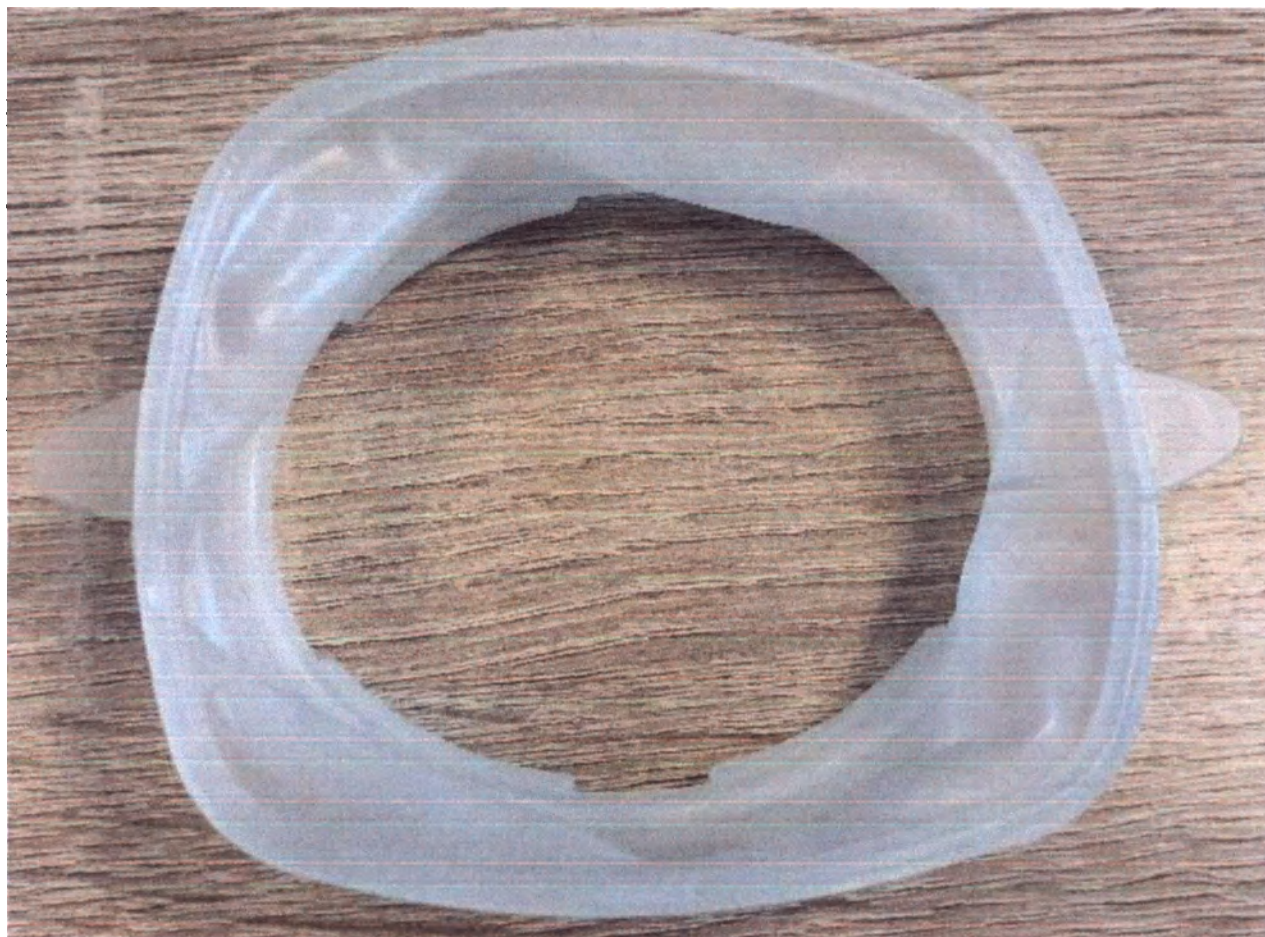

Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №4:

Ретрактор стоматологический одноразовый DENTAL FORMULA, размер: S+M, цвет: белый.

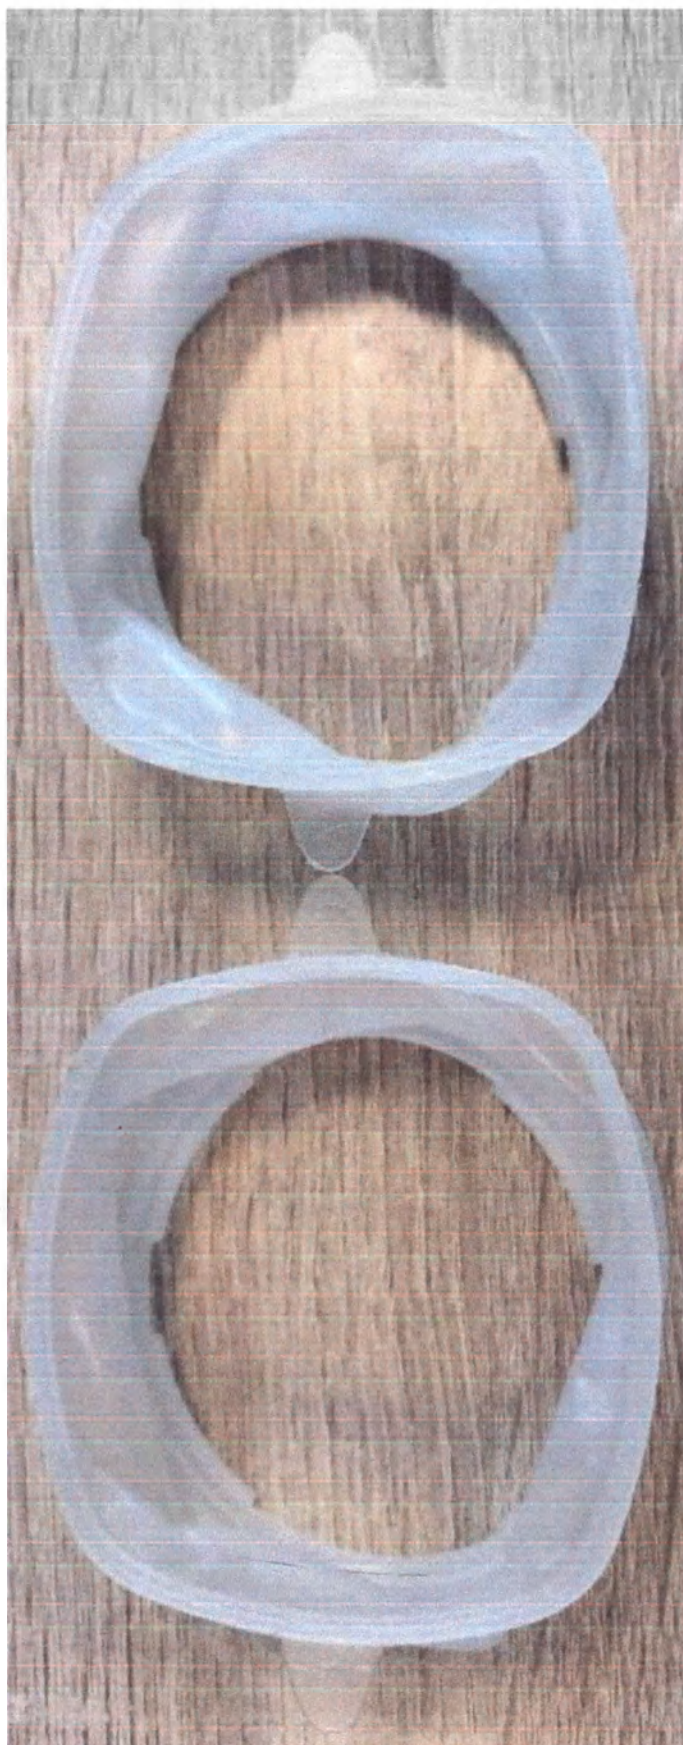



ВСЕГО ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 5 ЛИСТА/ОВ/
УПРАВЛЯЮЩИЙ-ИП
ПОТАКА В.Ф.

[Handwritten signature]