

«УТВЕРЖДАЮ»

АО «ПРОТЕКО»

Чекова Е.С.

на основании Доверенности № 78 АВ 4121305 от 19 июля 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Штифт стоматологический STEA®


Штифт Crystal Quartz Fiber Post "HS" HS90Q, в составе: 1,65-0,9-18мм – 10 шт./уп.



Штифт Crystal Quartz Fiber Post "911": 911-90Q, в составе: 1,45-0,9-16мм – 10 шт./уп.



Штифт Crystal Quartz Fiber Post "Cobra" CBC70Q, в составе: 1,2-0,7-16мм – 10 шт./уп.

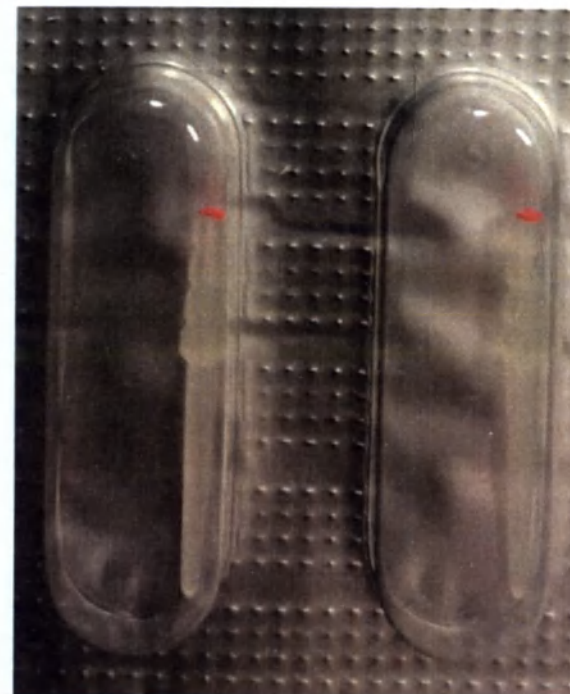

Штифт Red-Point Post "Cobra" CBC90QR, в составе: 1,4-0,9-16мм – 10 шт./уп.



Штифт Nano Ceramic Post "Simplex" SIM160QZ, в составе: 1,6-0,6-18мм – 10 шт./уп.




Штифт Nano Ceramic Post "Cobra" CBC110QZ, в составе: 1,6-1,1-16мм – 10 шт./уп.



Штифт Nano Ceramic Post "HS" HS70QZ, в составе: 1,45-0,7-18мм – 10 шт./уп.





Штифт Microcore ESSE Fiberpost "Conical" MCS22, в составе: 1,5-0,3-15,4мм – 10 шт./уп.

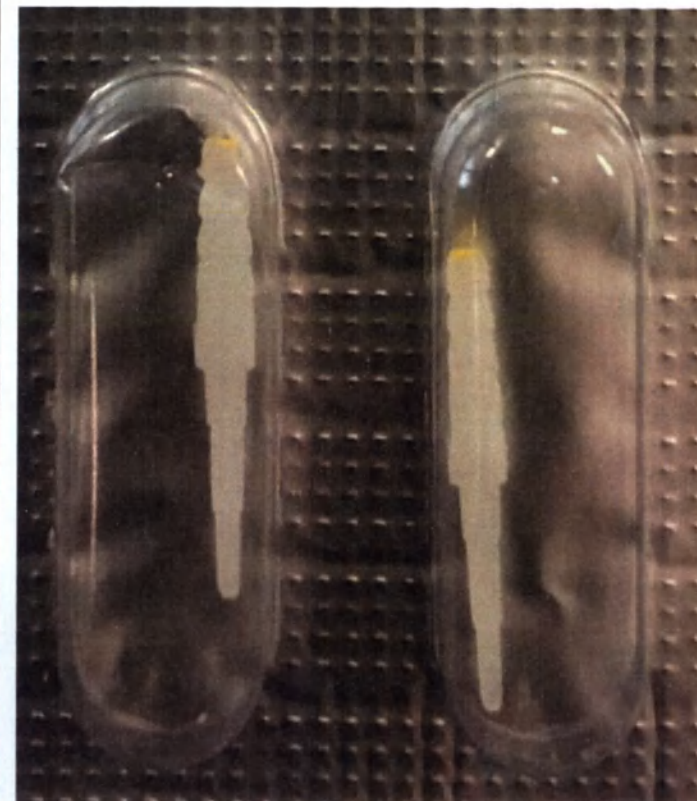

Штифт Microcore ESSE Fiberpost "Cylindrical" MCS8, в составе: 2,7-1,1-15,7мм – 10 шт./уп.




Штифт Standard Post "Simplex" SIM140V, в составе: 1,4-0,5-18мм – 10 шт./уп.

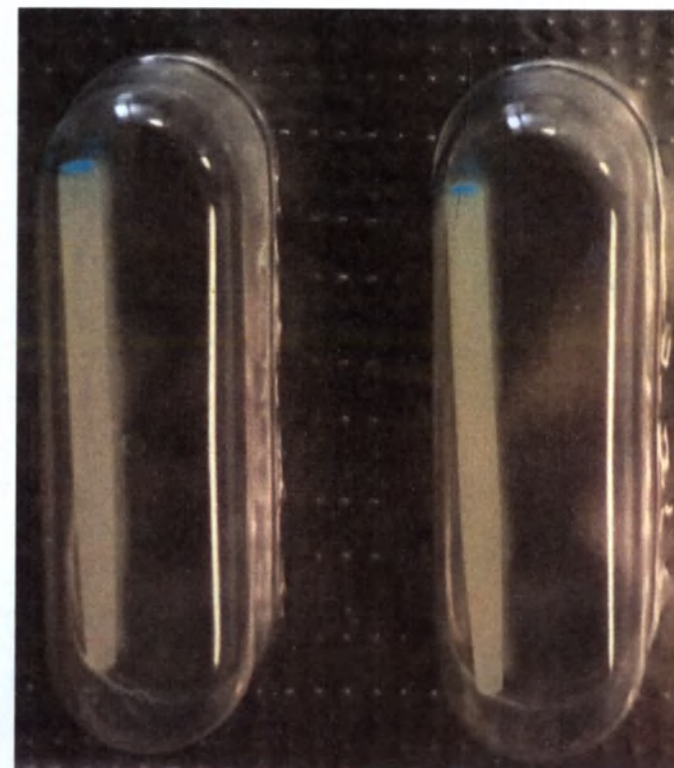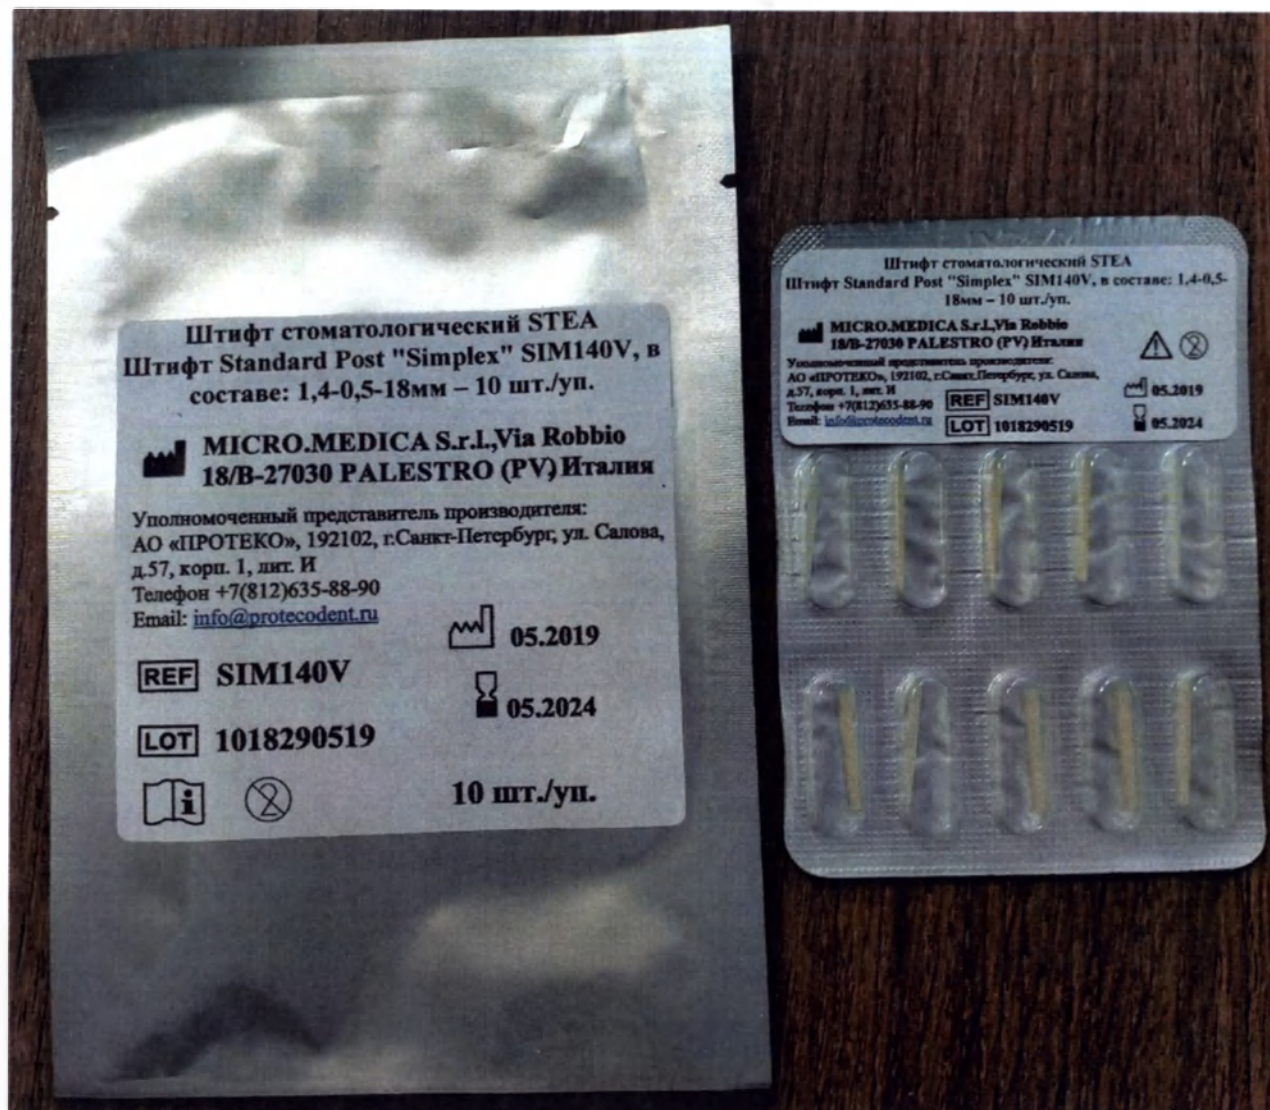

Штифт Standard Post "HS" HS90V, в составе: 1,65-0,9-18мм – 10 шт./уп.



Штифт Standard Post "mediXpost" MP60V, в составе: 1,26-0,6-16мм – 10 шт./уп.

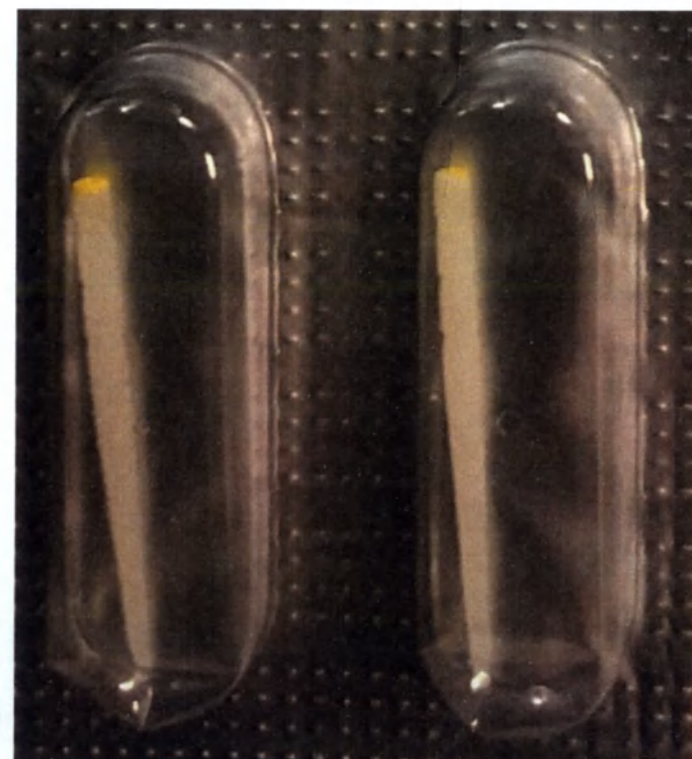



Штифт Standard Post "911" 911-70V, в составе: 1,25-0,7-16мм – 10 шт./уп.




Штифт Standard Post "Rapid" RA70V, в составе: 1,25-0,7-16мм – 10 шт./уп.



Штифт Standard Post "Cobra" CB120V, в составе: 1,4-1,2-16мм – 10 шт./уп.

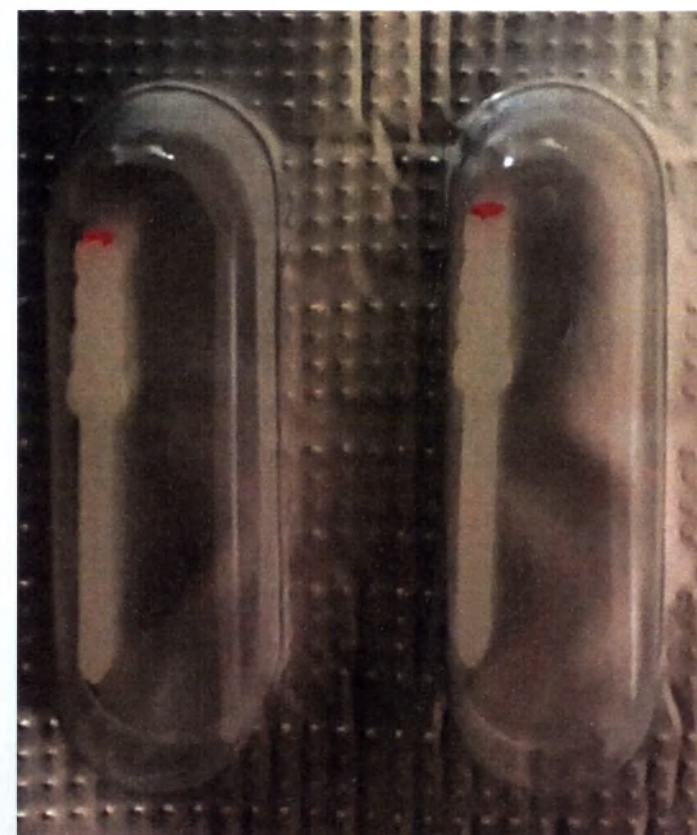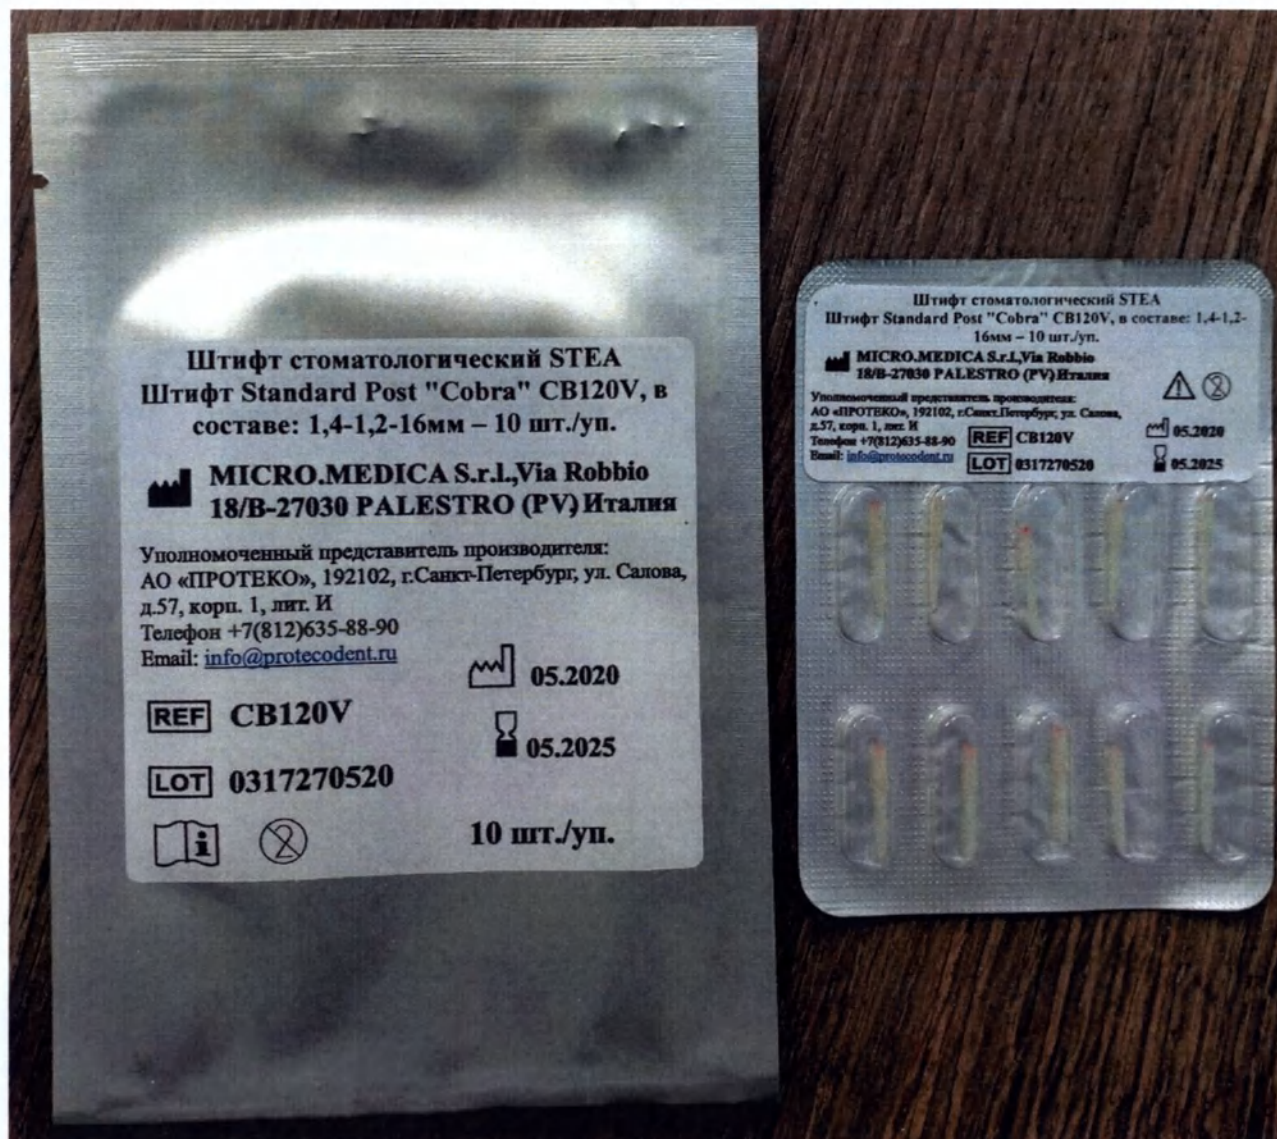


Штифт Standard Post "Hi Techno" HT30V, в составе: 1,26-0,3-20мм – 10 шт./уп.

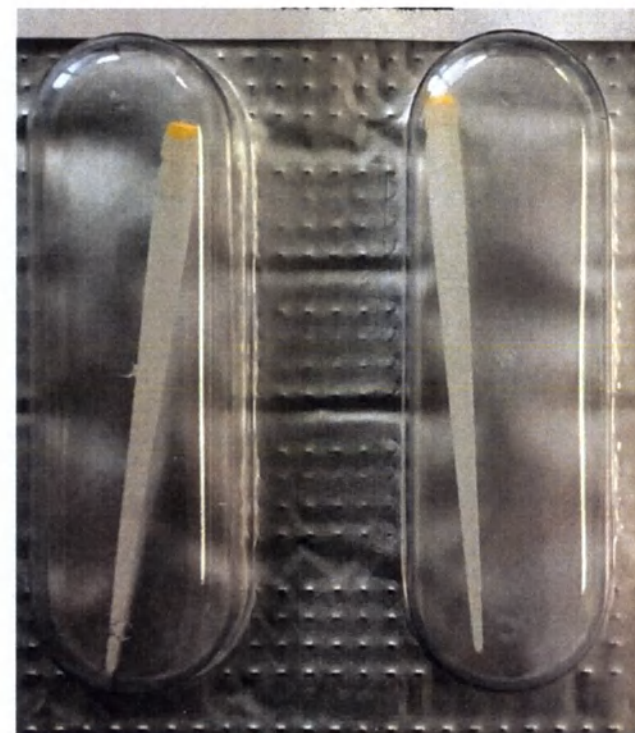


Набор штифтов стоматологических STEA Standard Post "Hi Techno" HTVSET, в составе:

- Штифт 1,21-0,25-20мм – 5 шт.
- Штифт 1,26-0,3-20мм – 5 шт.
- Штифт 1,31-0,35-20мм – 5 шт.
- Штифт 1,36-0,4-20мм – 5 шт.
- Штифт 1,41-0,5-20мм – 5 шт.
- Штифт 1,46-0,6-20мм – 5 шт.

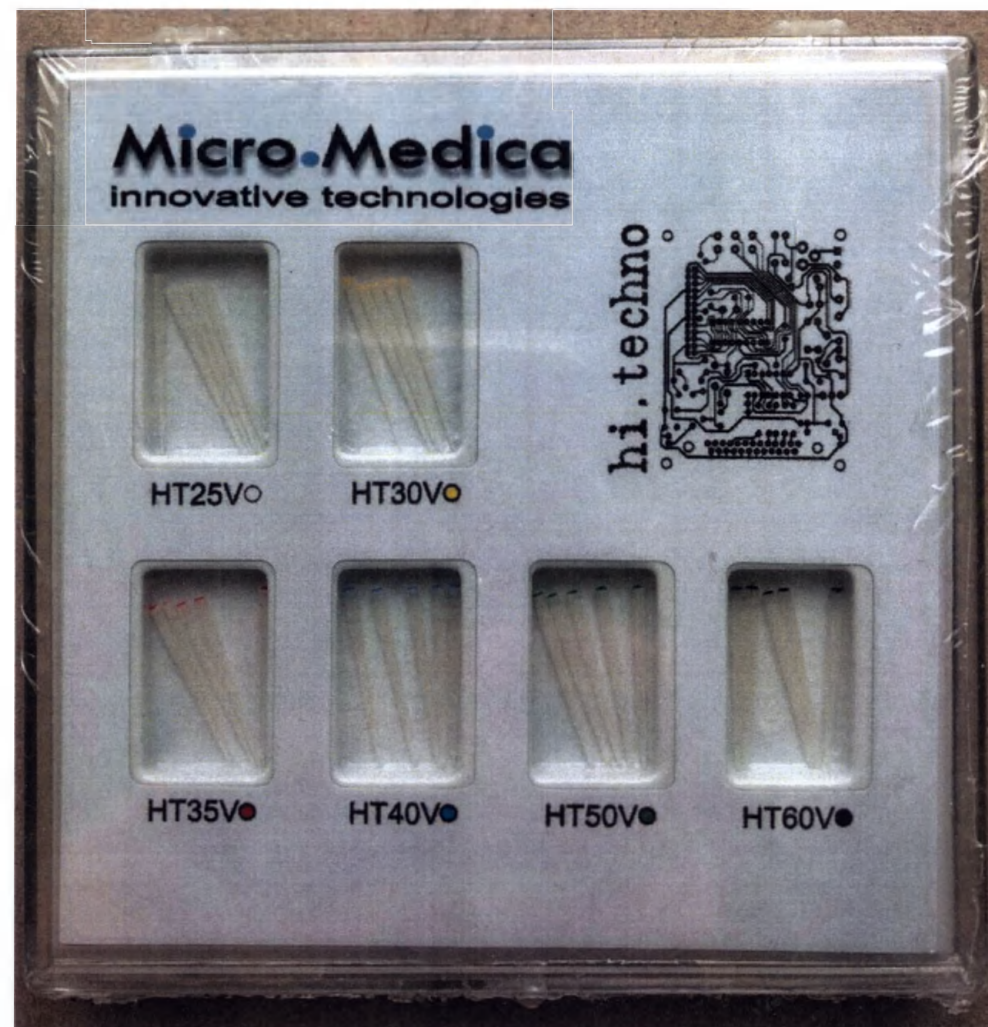

Проект маркировки блистера на примере варианта исполнения: Штифт Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" SIM100Q, в составе: 1,0-0,3-18мм – 10 шт./уп.

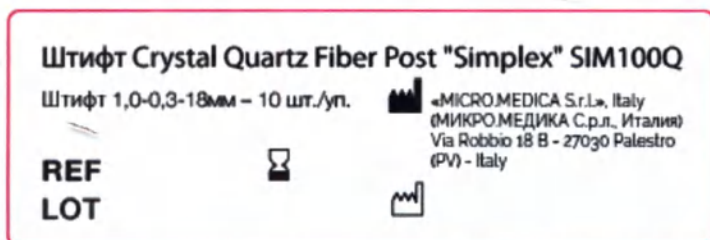

Проект маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения: Штифт Crystal Quartz Fiber Post "Simplex" SIM100Q, в составе: 1,0-0,3-18мм – 10 шт./уп.



Проект маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения: Штифт Standard Post "Hi Techno" HTVSET, в составе: 1,21-0,25-20мм (5 шт.); 1,26-0,3-20мм (5 шт.); 1,31-0,35-20мм (5 шт.); 1,36-0,4-20мм (5 шт.); 1,41-0,5-20мм (5 шт.); 1,46-0,6-20мм (5 шт.) – 30 шт./уп.

STEA®

endodontic

Standard Post "Hi Techno"

Штифт Standard Post "Hi Techno" HTVSET.

В составе:

Штифт 1,21-0,25-20мм (5 шт.); 1,26-0,3-20мм (5 шт.); 1,31-0,35-20мм (5 шт.);
1,36-0,4-20мм (5 шт.); 1,41-0,5-20мм (5 шт.); 1,46-0,6-20мм (5 шт.) – 30 шт./уп.



protecodent.ru

Штифты изготовлены из кварцевого стекловолокна.

Срок годности: 5 лет.

РУ № _____ от _____

Уполномоченный представитель

производителя в РФ:

АО «ПРОТЕКО» 192102, г. Санкт-Петербург,

ул. Салова, д.57, корп.1, лит. И.

тел.: +7 (812) 779-30-90, info@protecodent.ru,

www.protecodent.ru



«MICRO.MEDICA S.r.l.», Italy
(МИКРО.МЕДИКА С.р.л., Италия)
Via Robbio 18 B - 27030 Palestro
(PV) - Italy



REF

LOT



Наименование и торговая марка изделия.

(Не указывается, если в транспортной упаковке содержатся несколько наименований изделий)



«MICRO.MEDICA S.r.l.», Italy
Via Robbio 18 B - 27030 Palestro (PV) - Italy
Телефон: +39 0384 672867
Факс: +39 0384 682912
www.micromedicasrl.it

+5°C .  +30°C

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

22 (двадцать один) листа(ов)
АО «ПРОТЕКО» Чекова Е.С.

на основании Доверенности № 78 АВ 4121305 от 19.07.2023 г.

