

Руководитель группы регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А.Горшкова



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Система ультразвуковая диагностическая,
варианты исполнения: ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite с принадлежностями

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2 с принадлежностями»

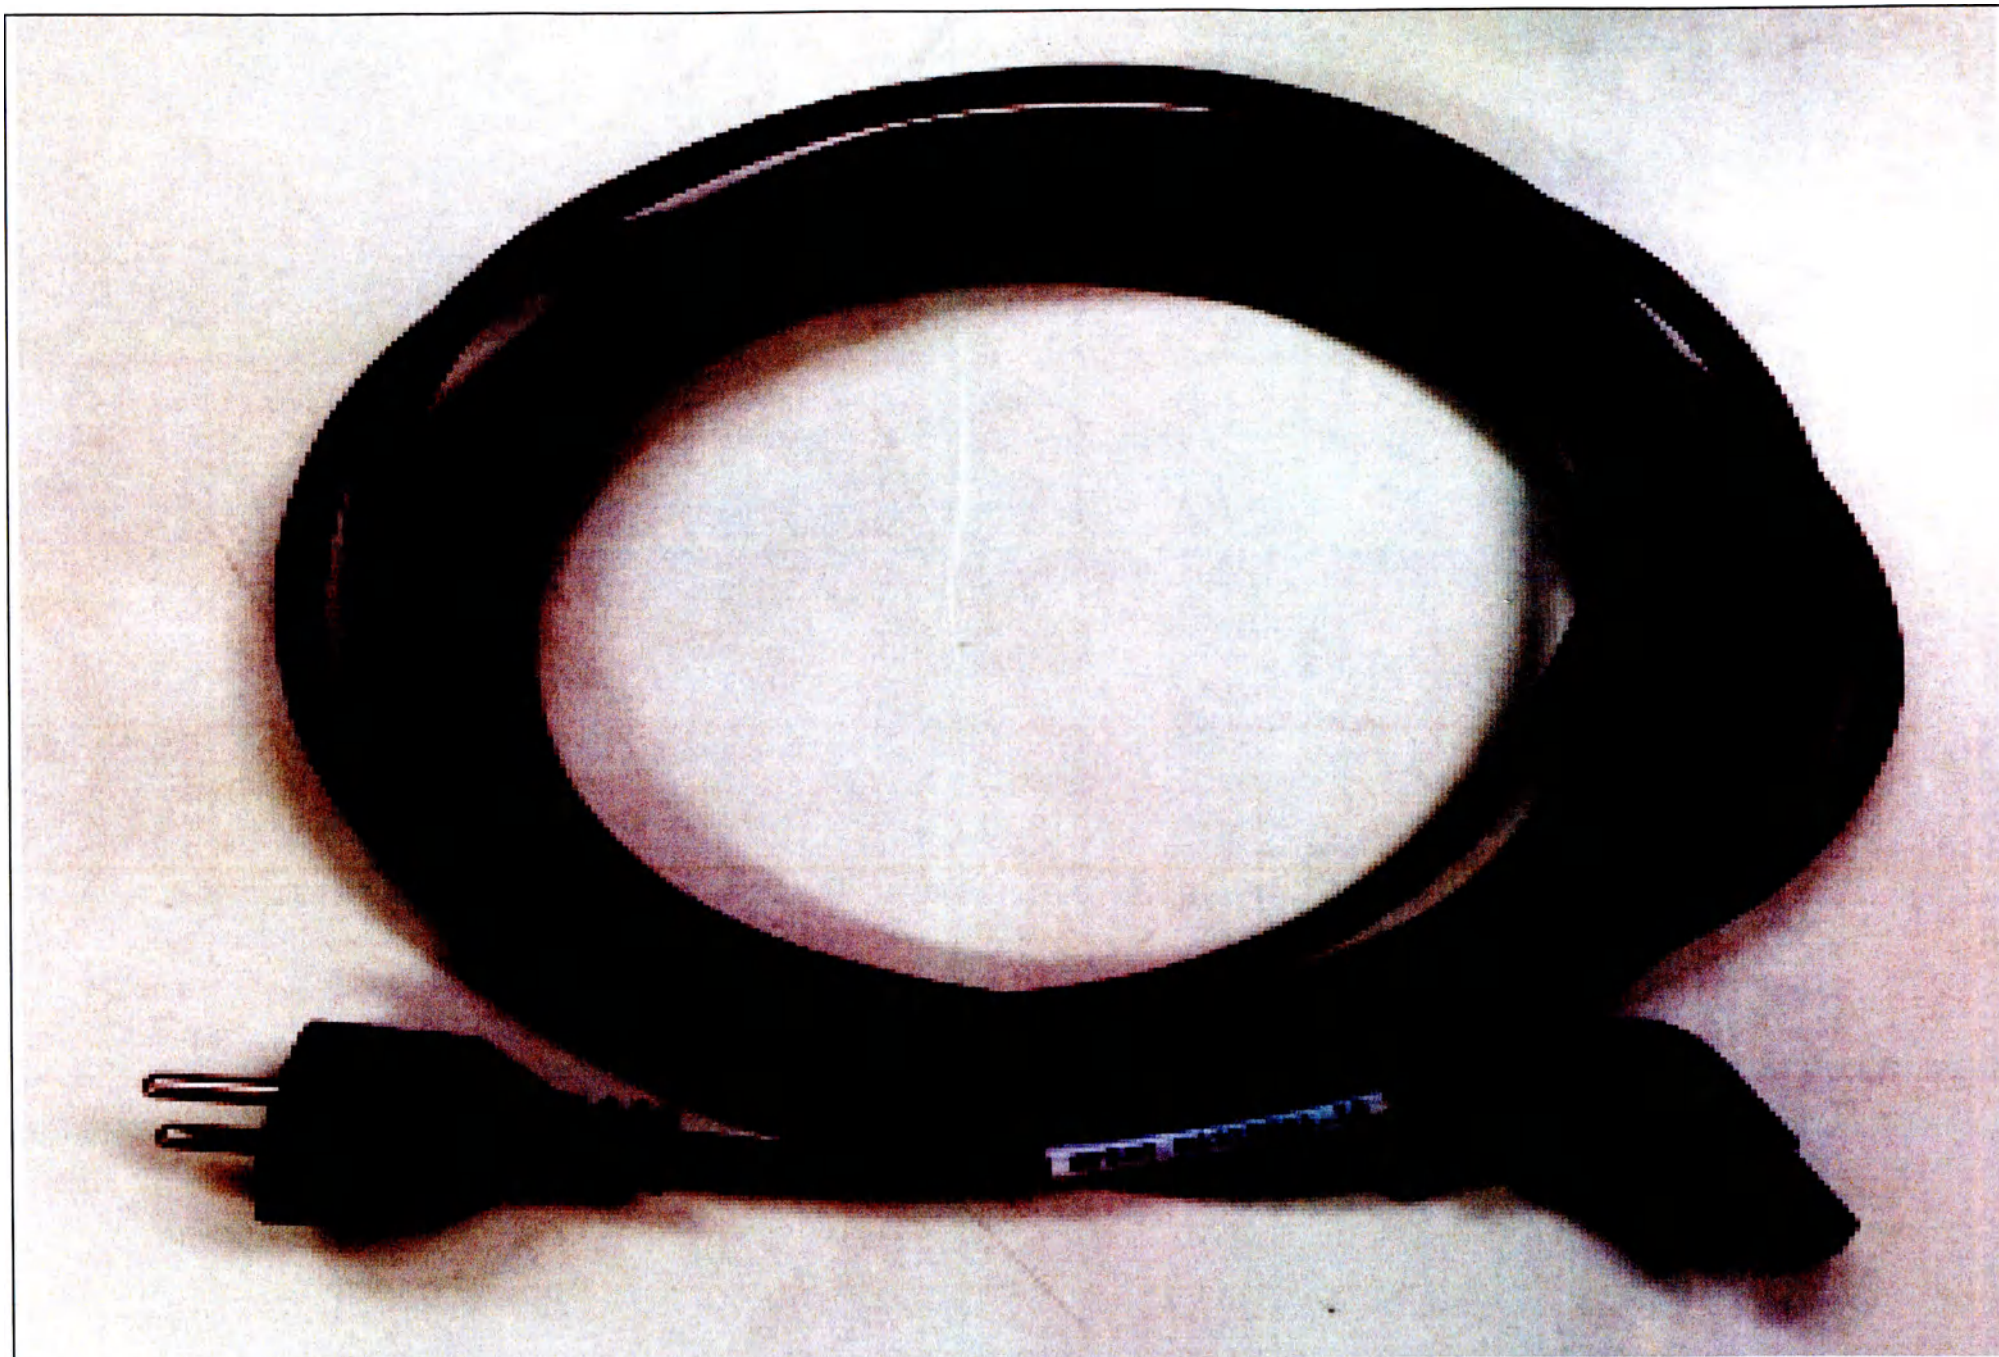


Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия: Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2

Фотографические изображения базового блока медицинского изделия:
**«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения:
ACUSON NX2 с принадлежностями»**



Рисунок 2. Система ультразвуковая диагностическая ACUSON NX2




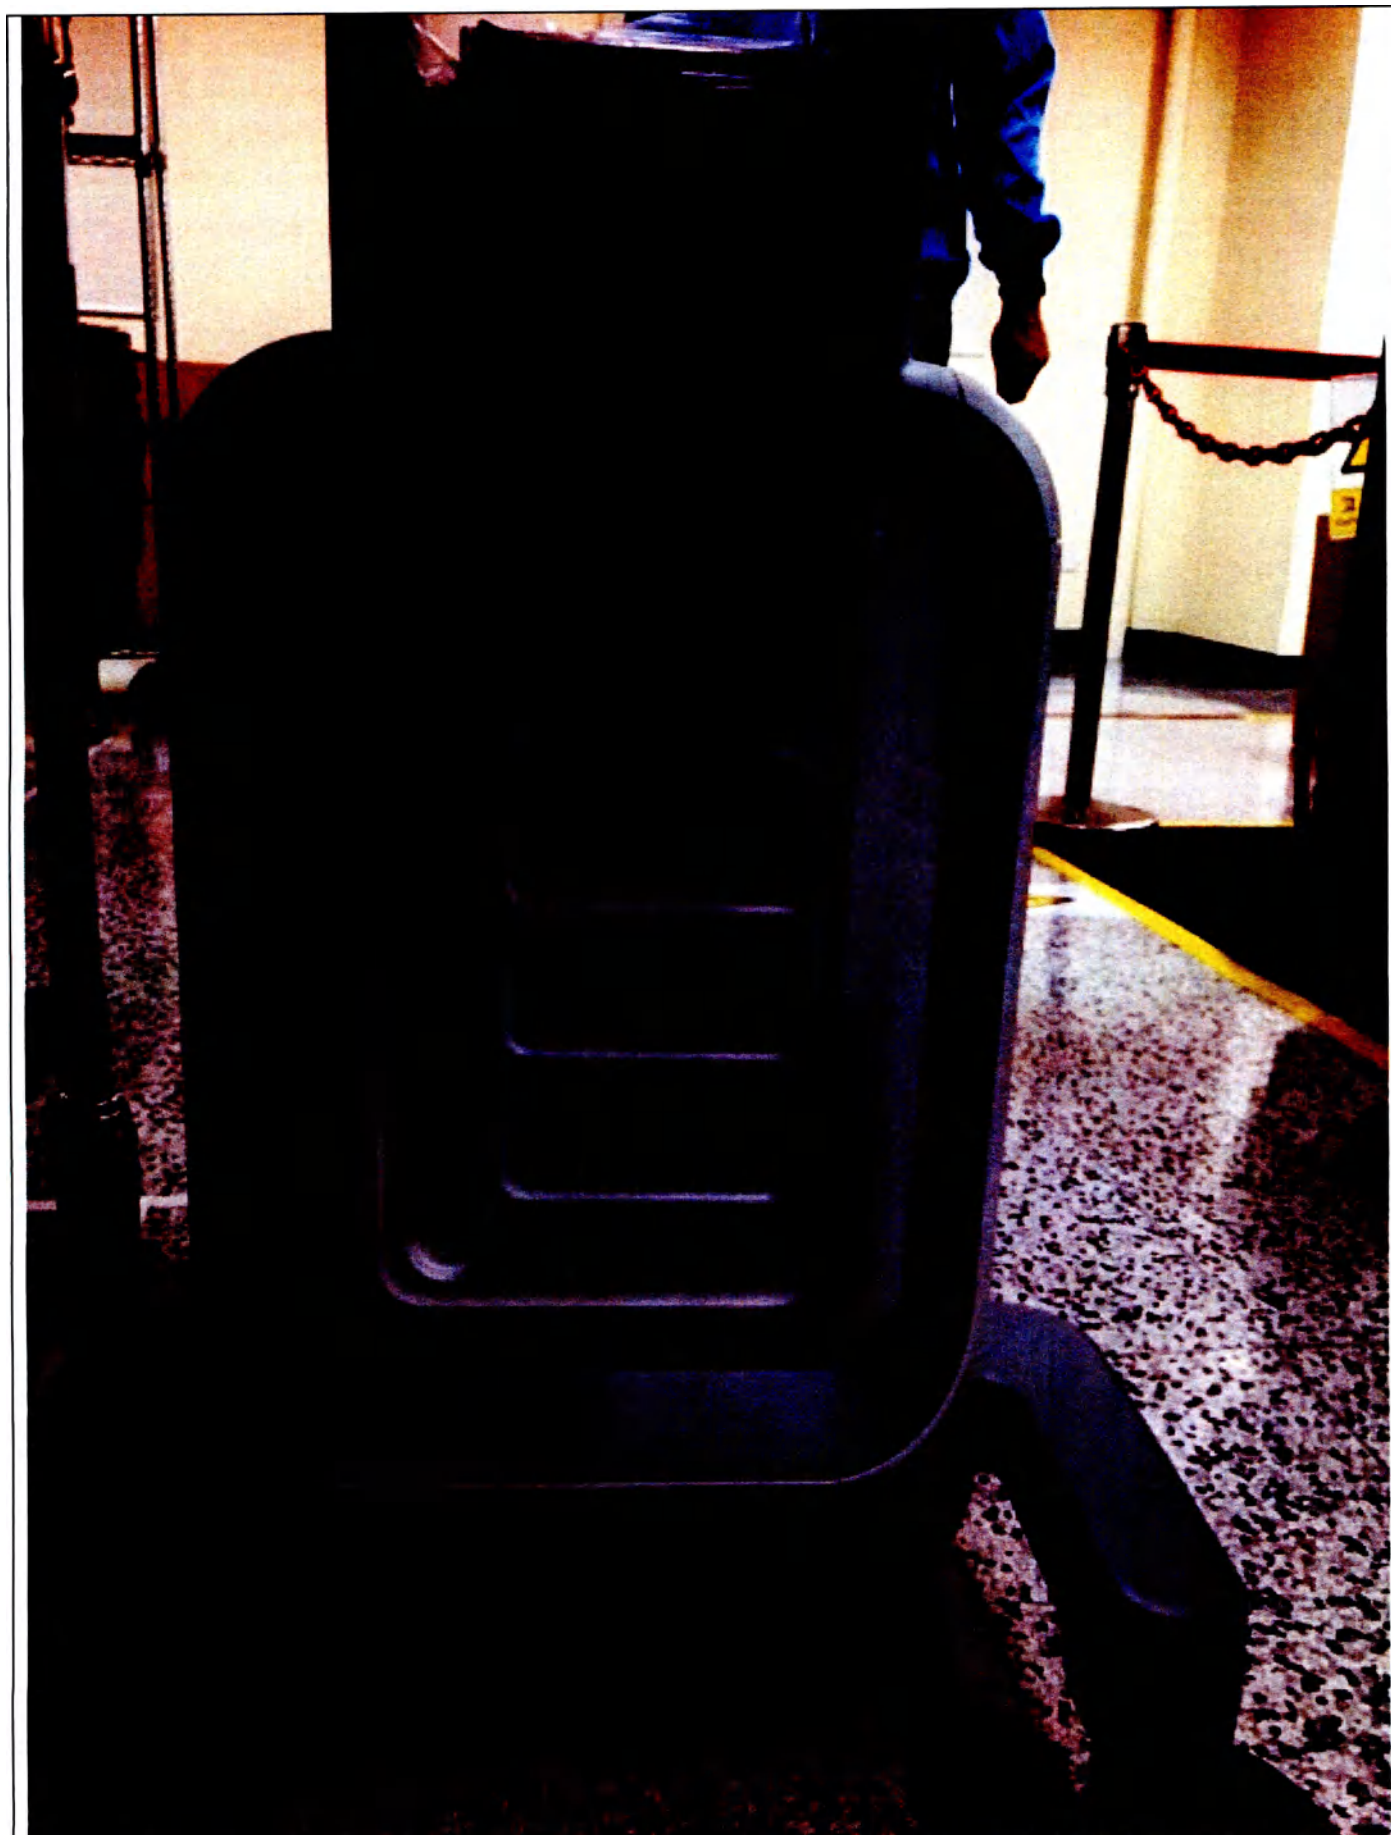



Рисунок 4. Дополнительный активный порт для подключения датчиков








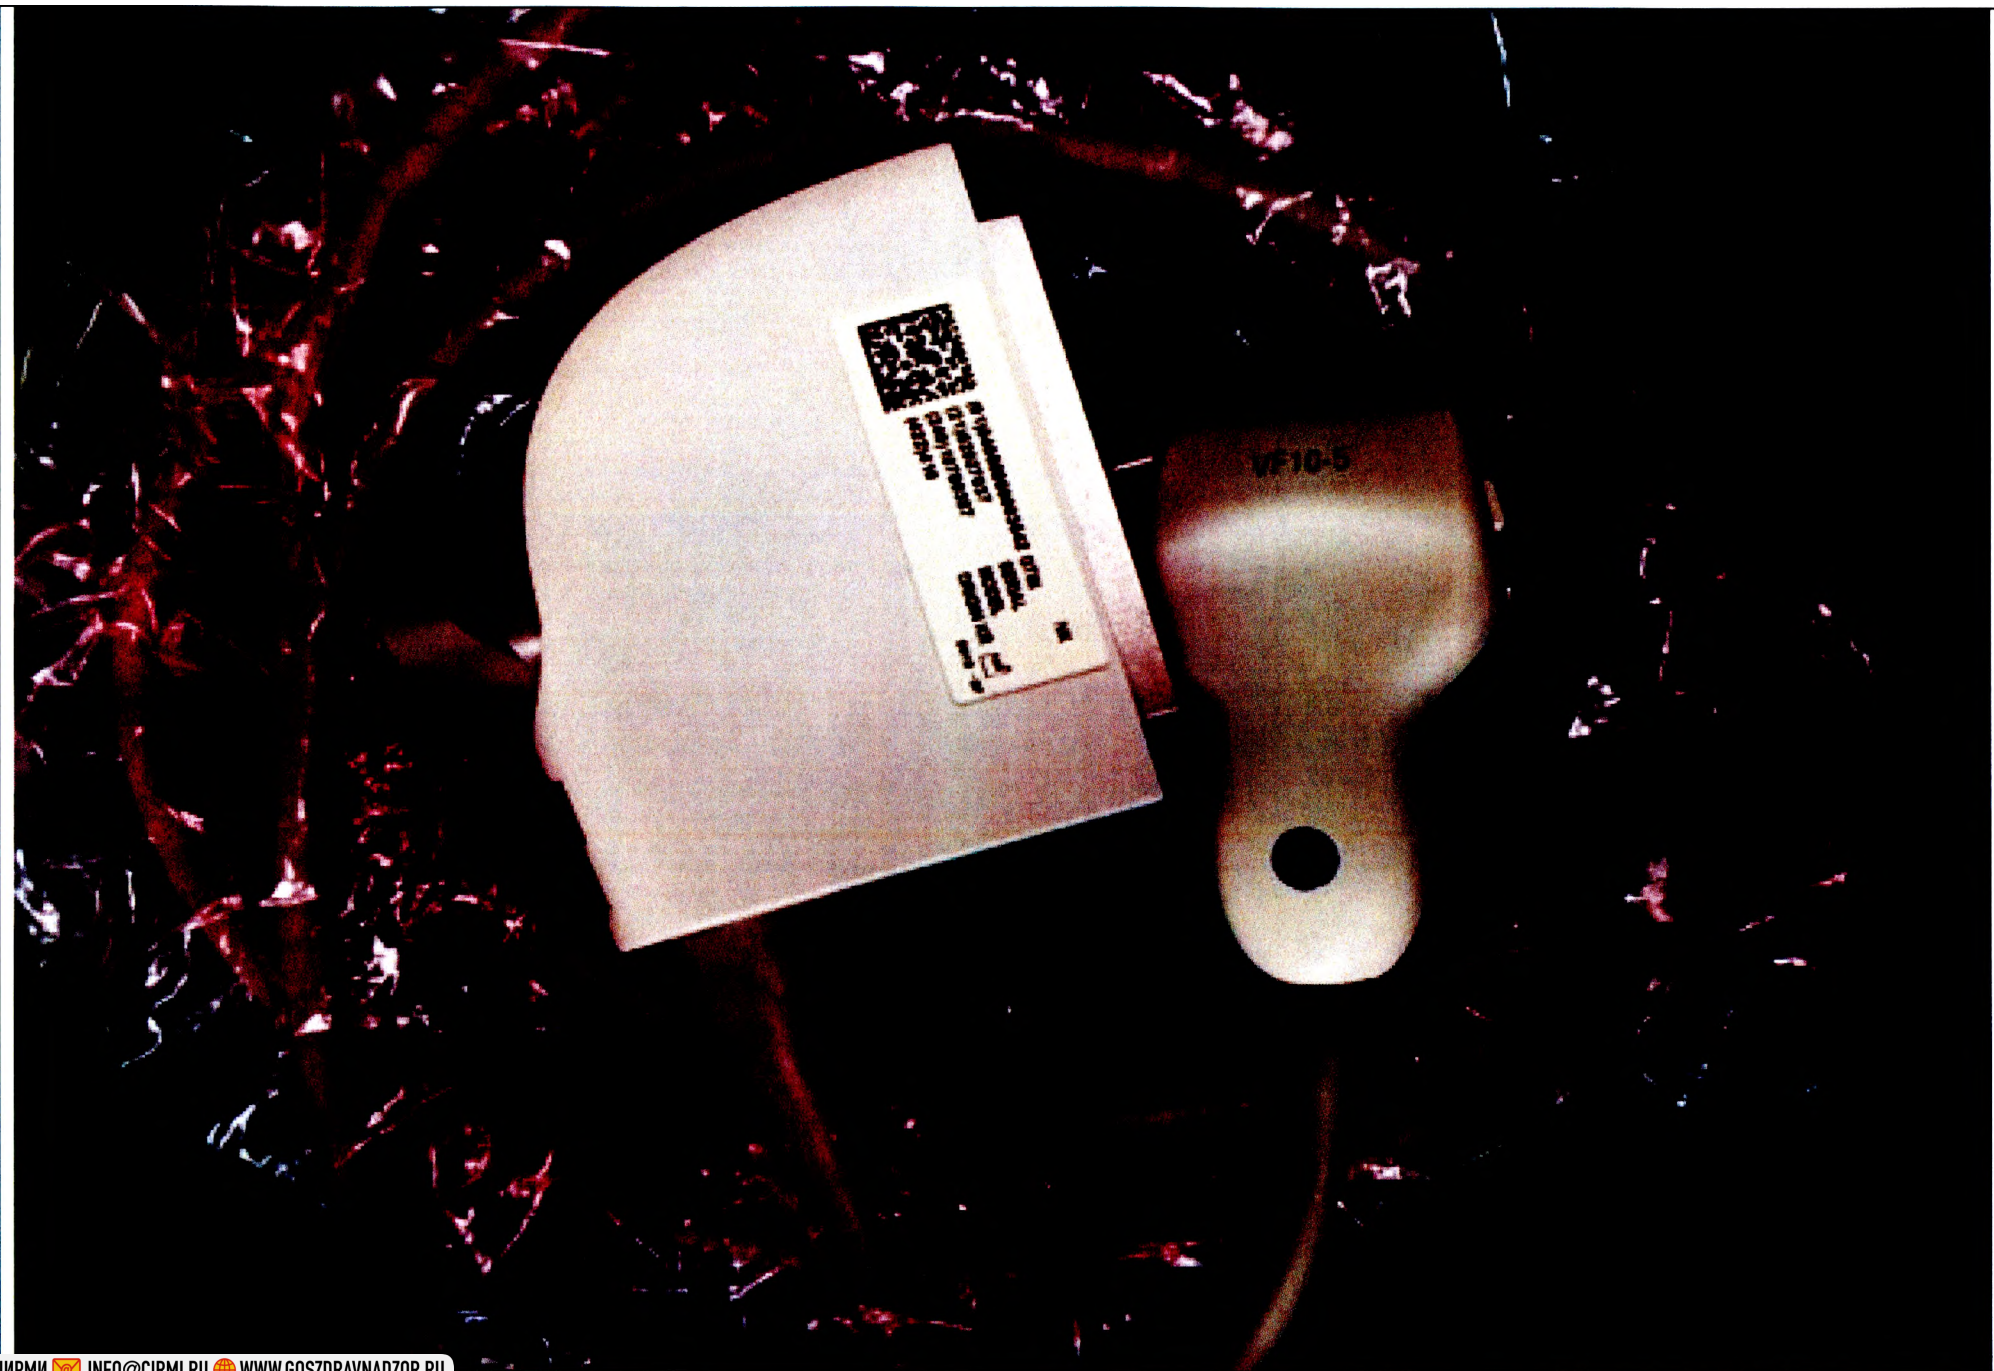


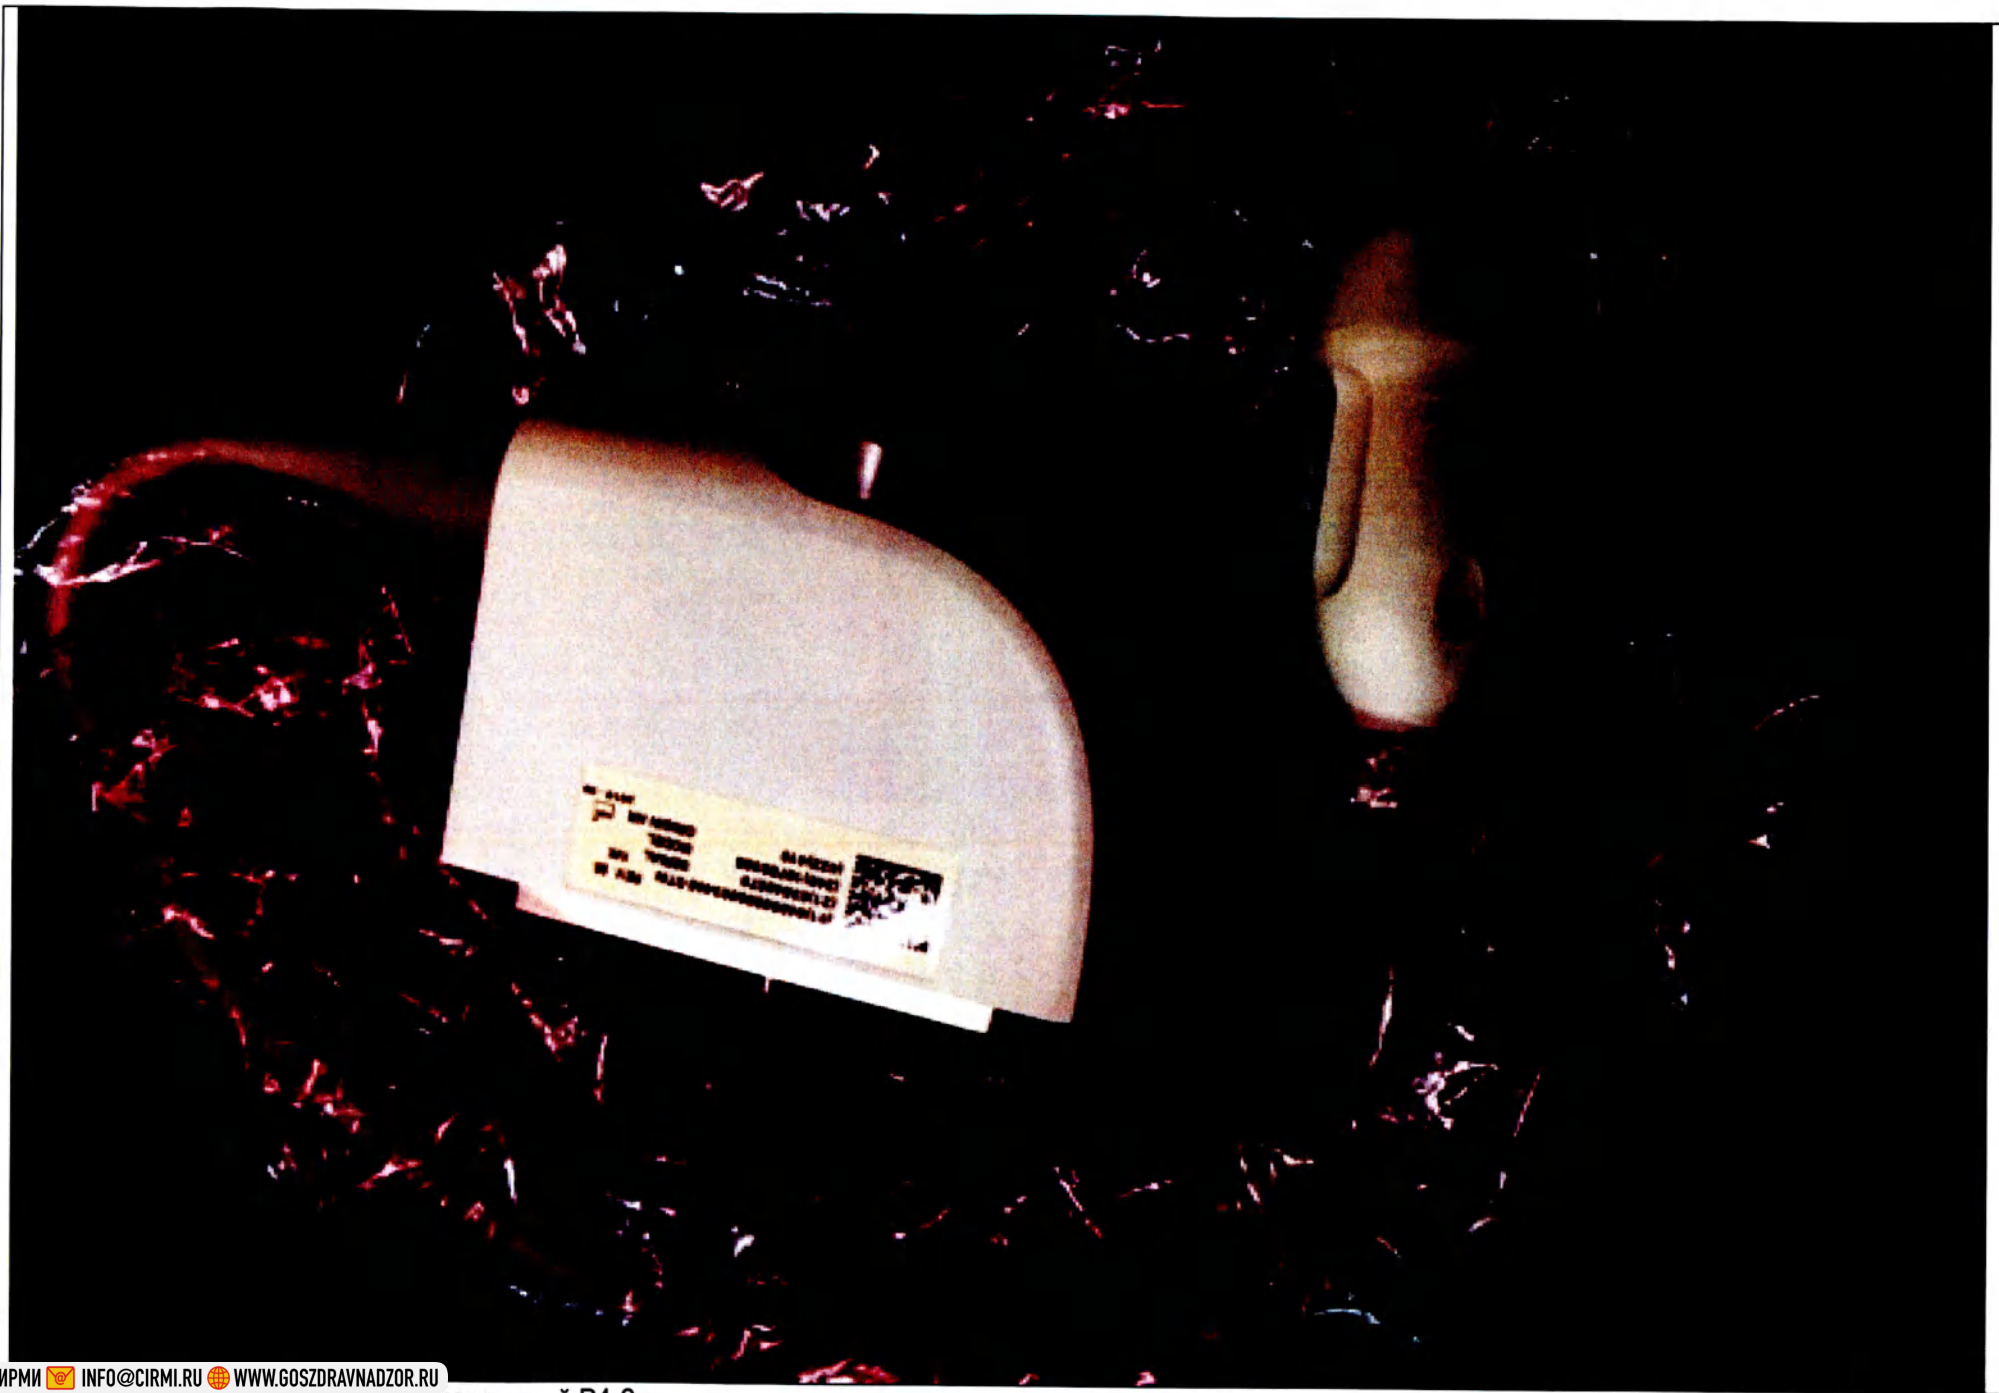




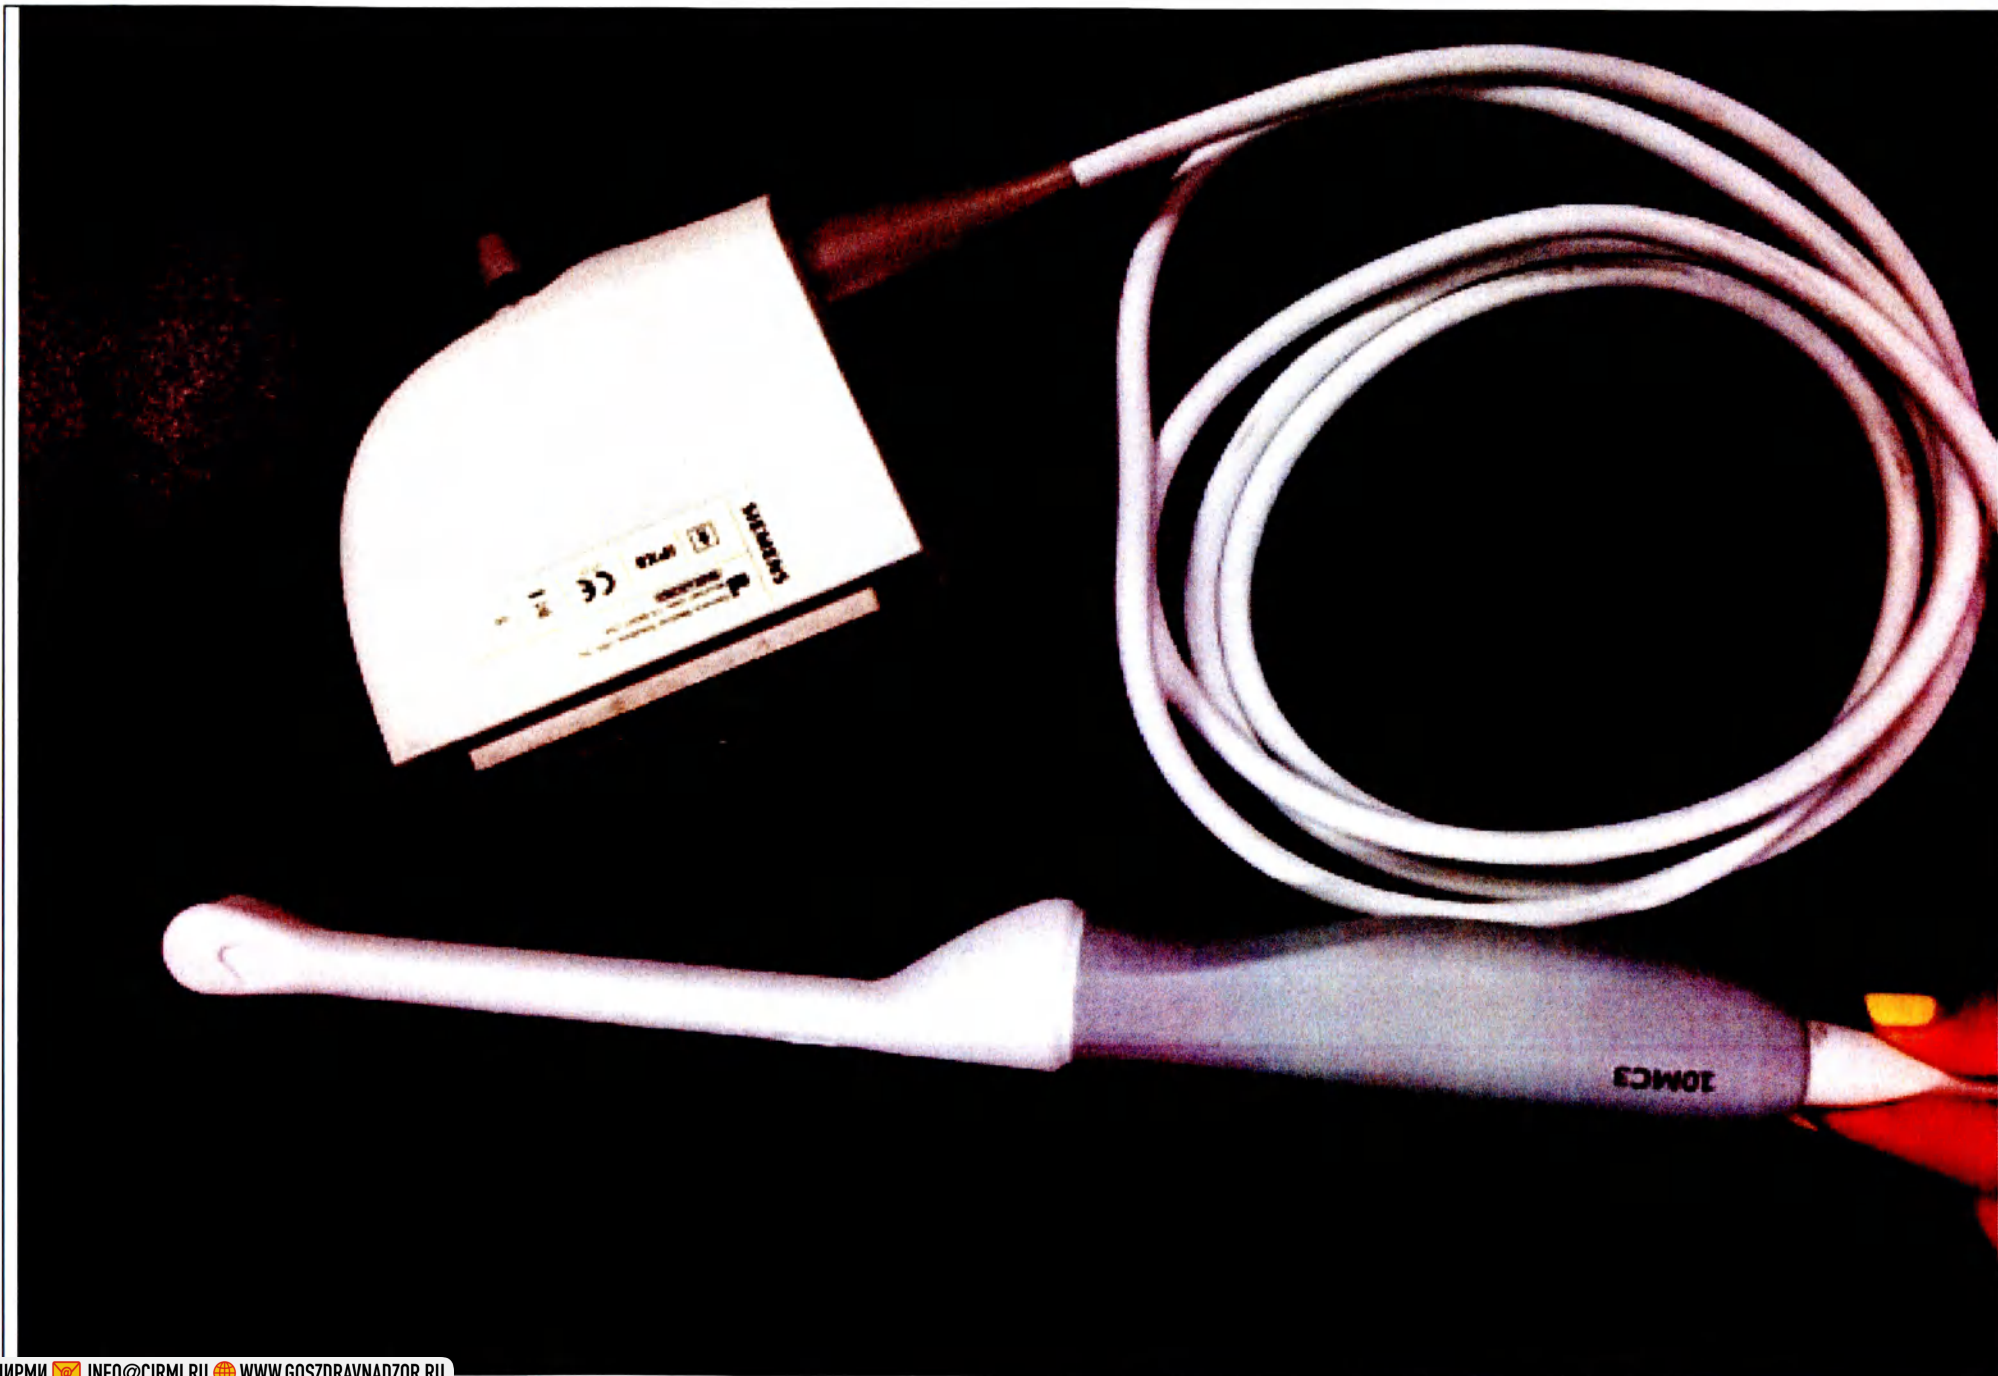



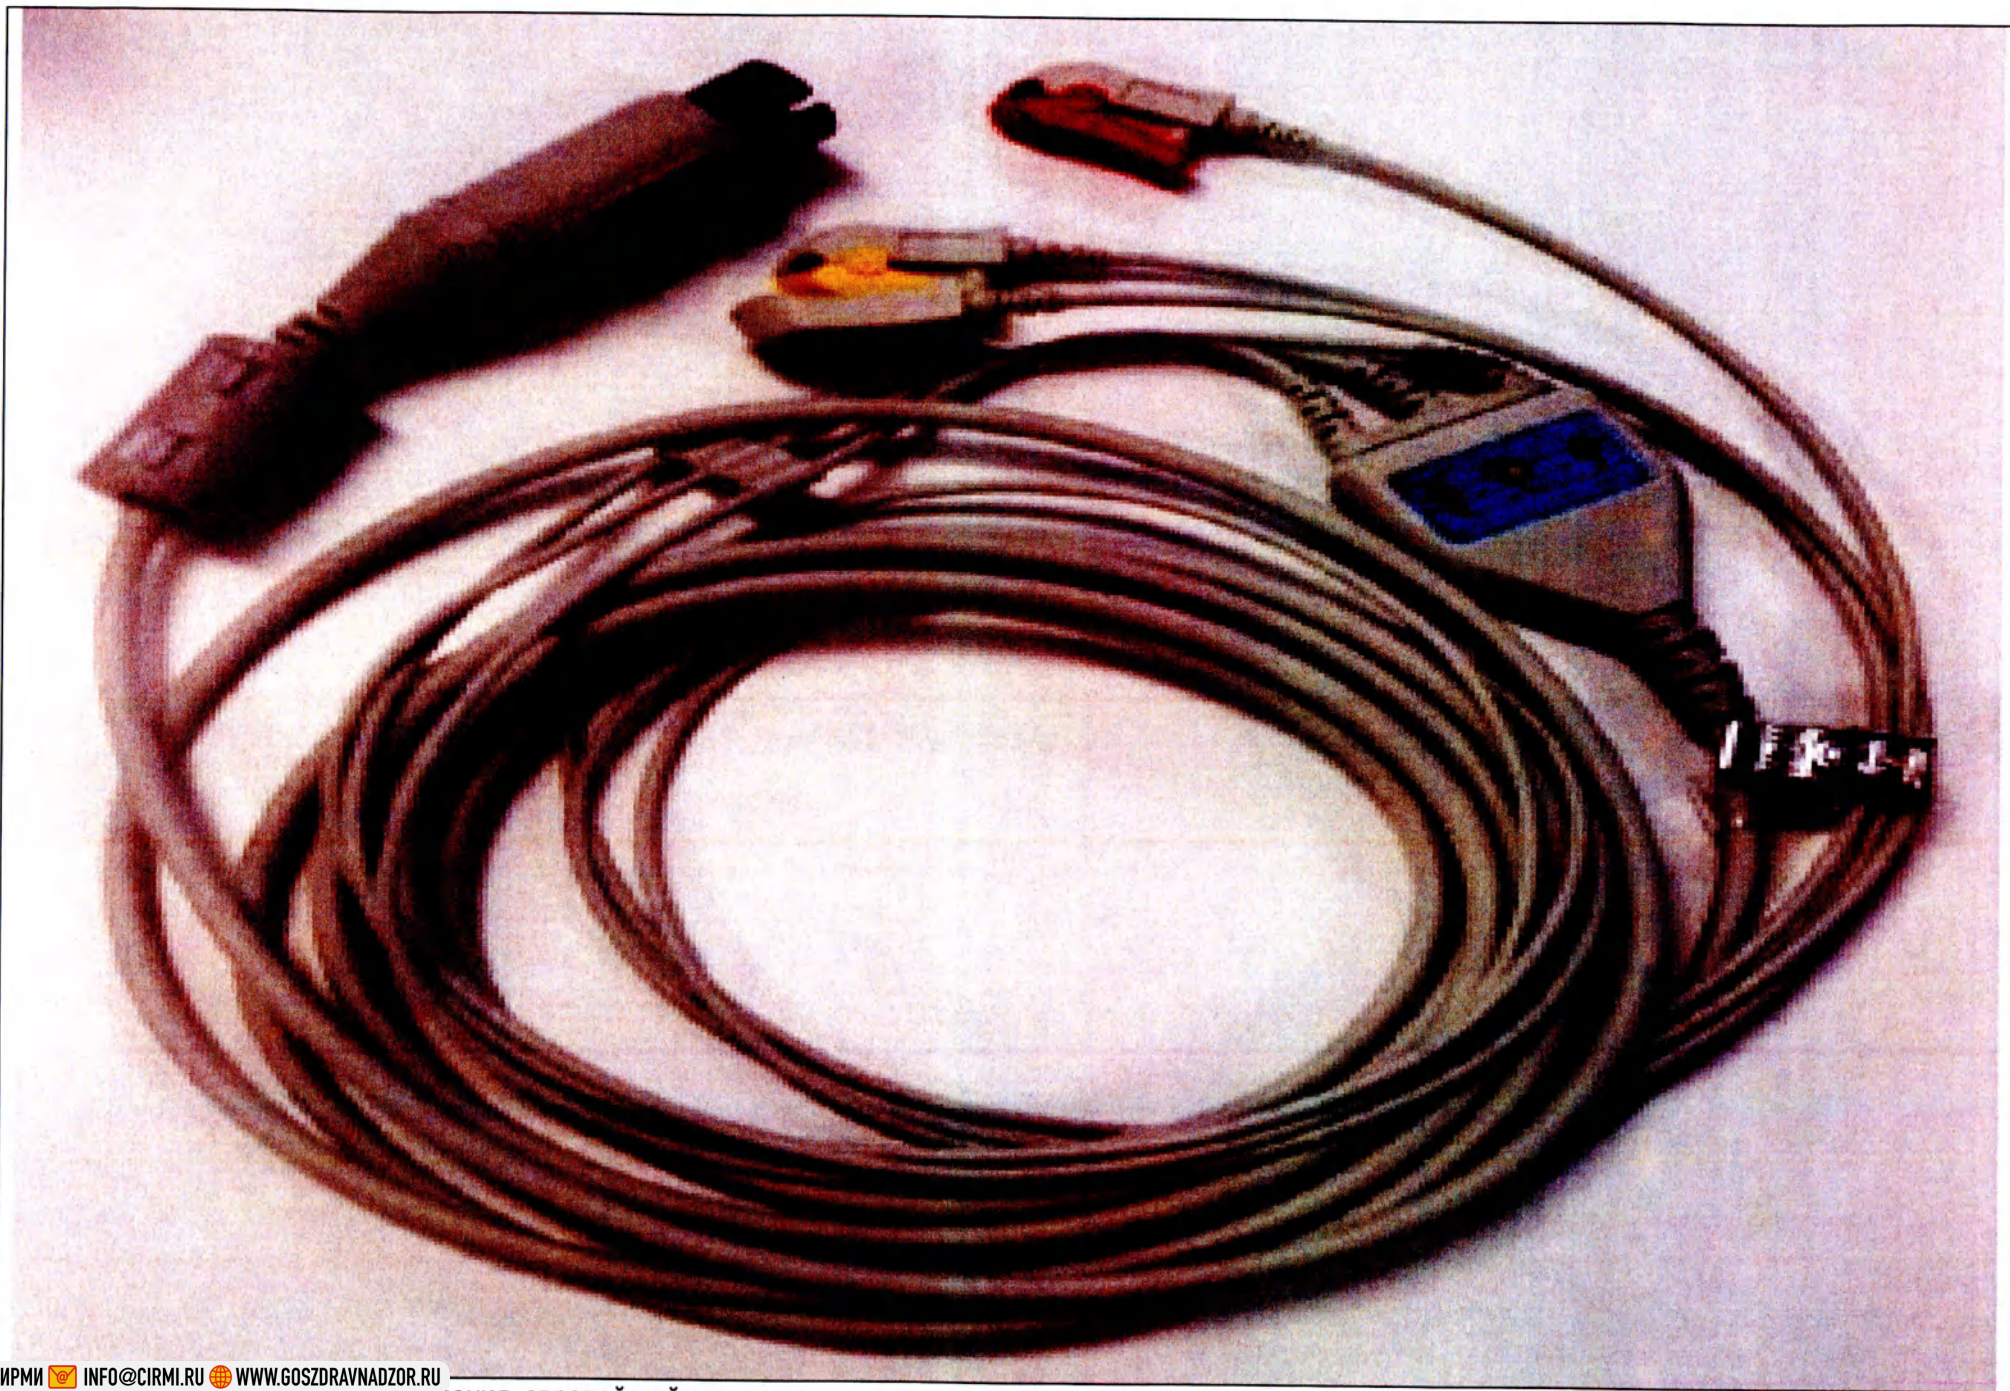

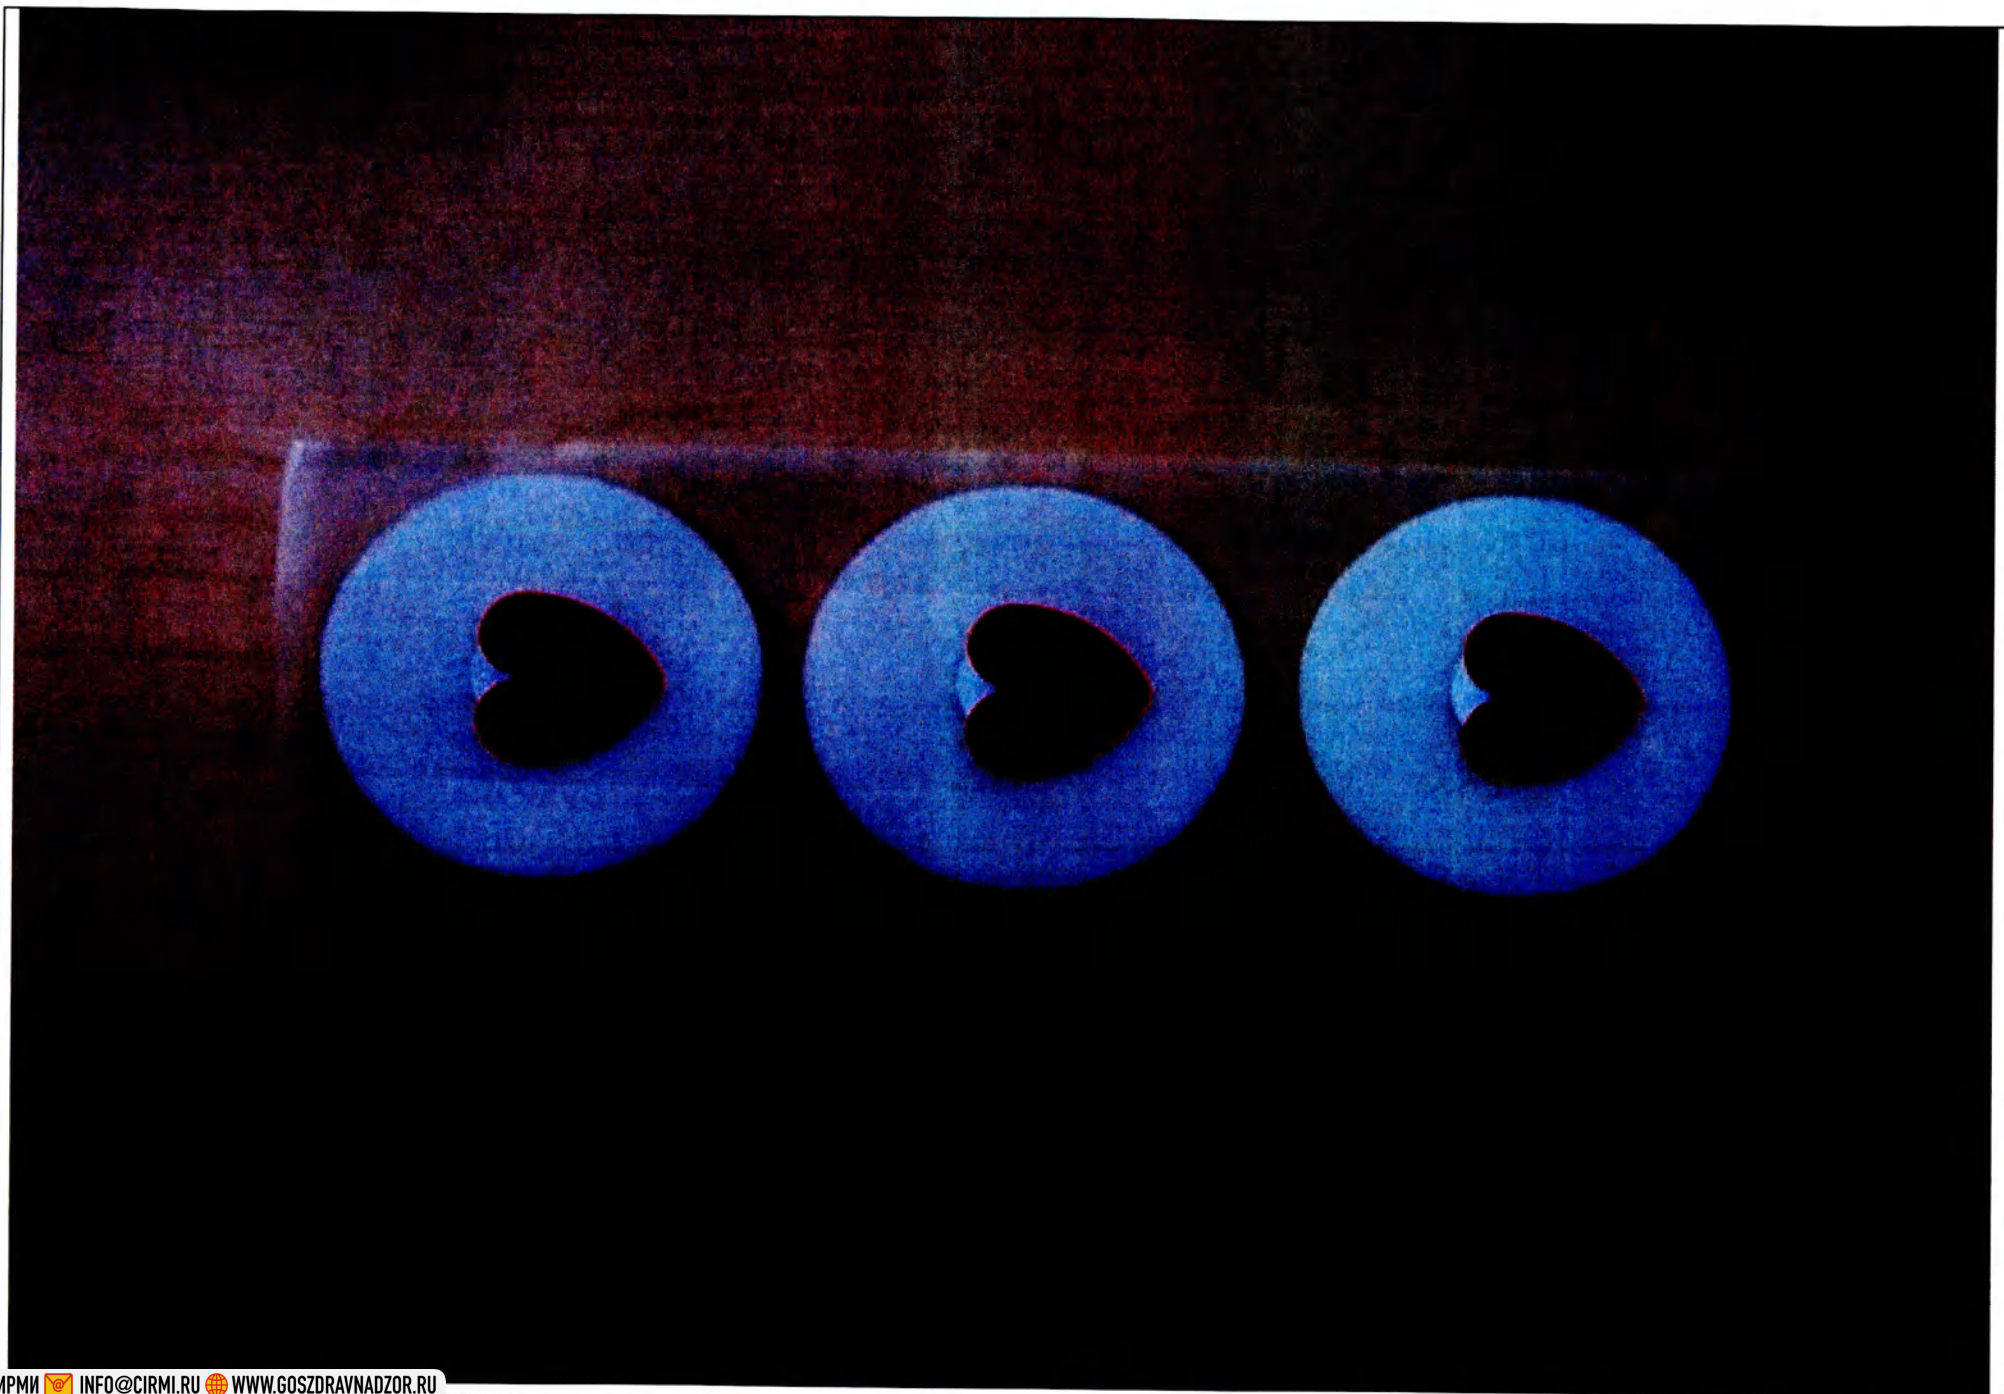

SIEMENS

Система ультразвуковая диагностическая,
варианты исполнения:

ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite с

принадлежностями

Инструкция по эксплуатации

US

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
PROPERTY AND CONFIDENTIAL - DO NOT DUPLICATE OR DISSEMINATE
PRELIMINARY, UNRELEASED

CE
0123

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

11361350-02

Рисунок 15. Документация пользователя на русском языке

Приложение к инструкции по эксплуатации для России

Система ультразвуковая диагностическая, варианты
исполнения: ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite
с принадлежностями

Рисунок 16. Приложение к Инструкции по эксплуатации для России.

Фотографические изображения общего медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2 Elite»

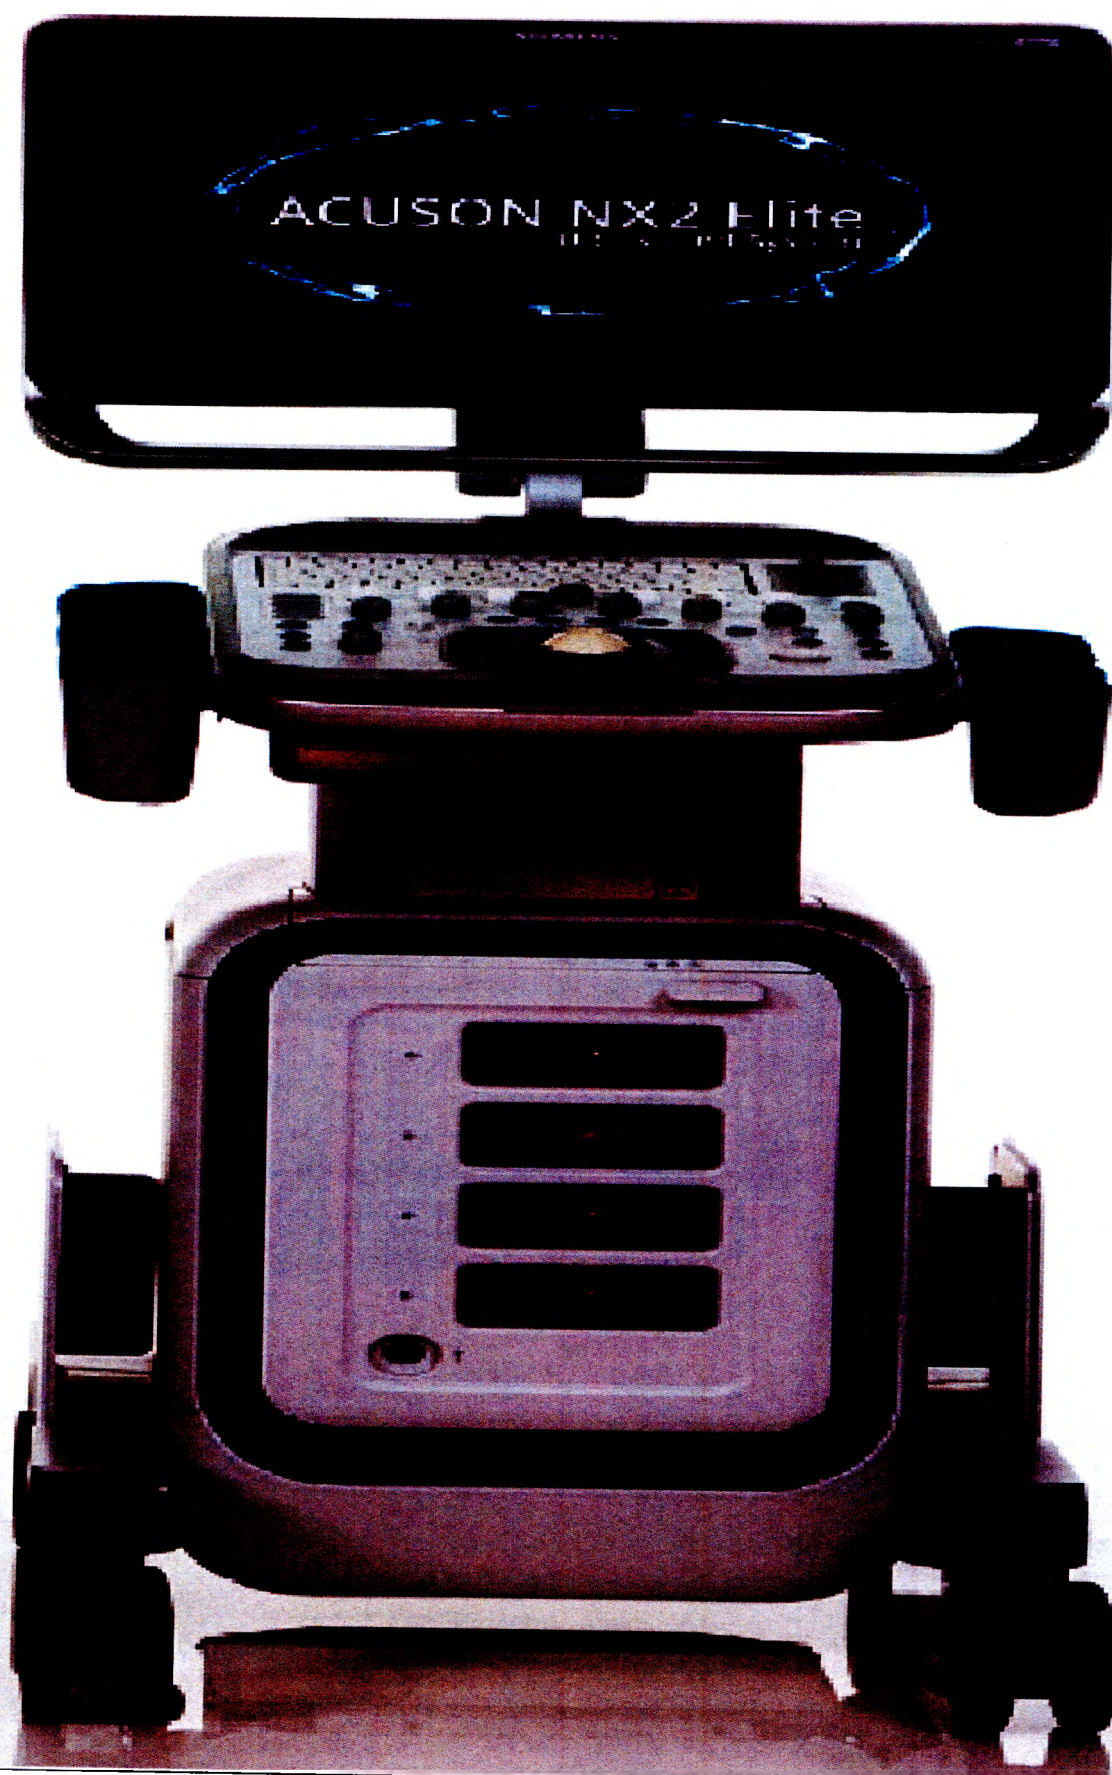


Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2 Elite

Фотографические изображения базового блока медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2 Elite»

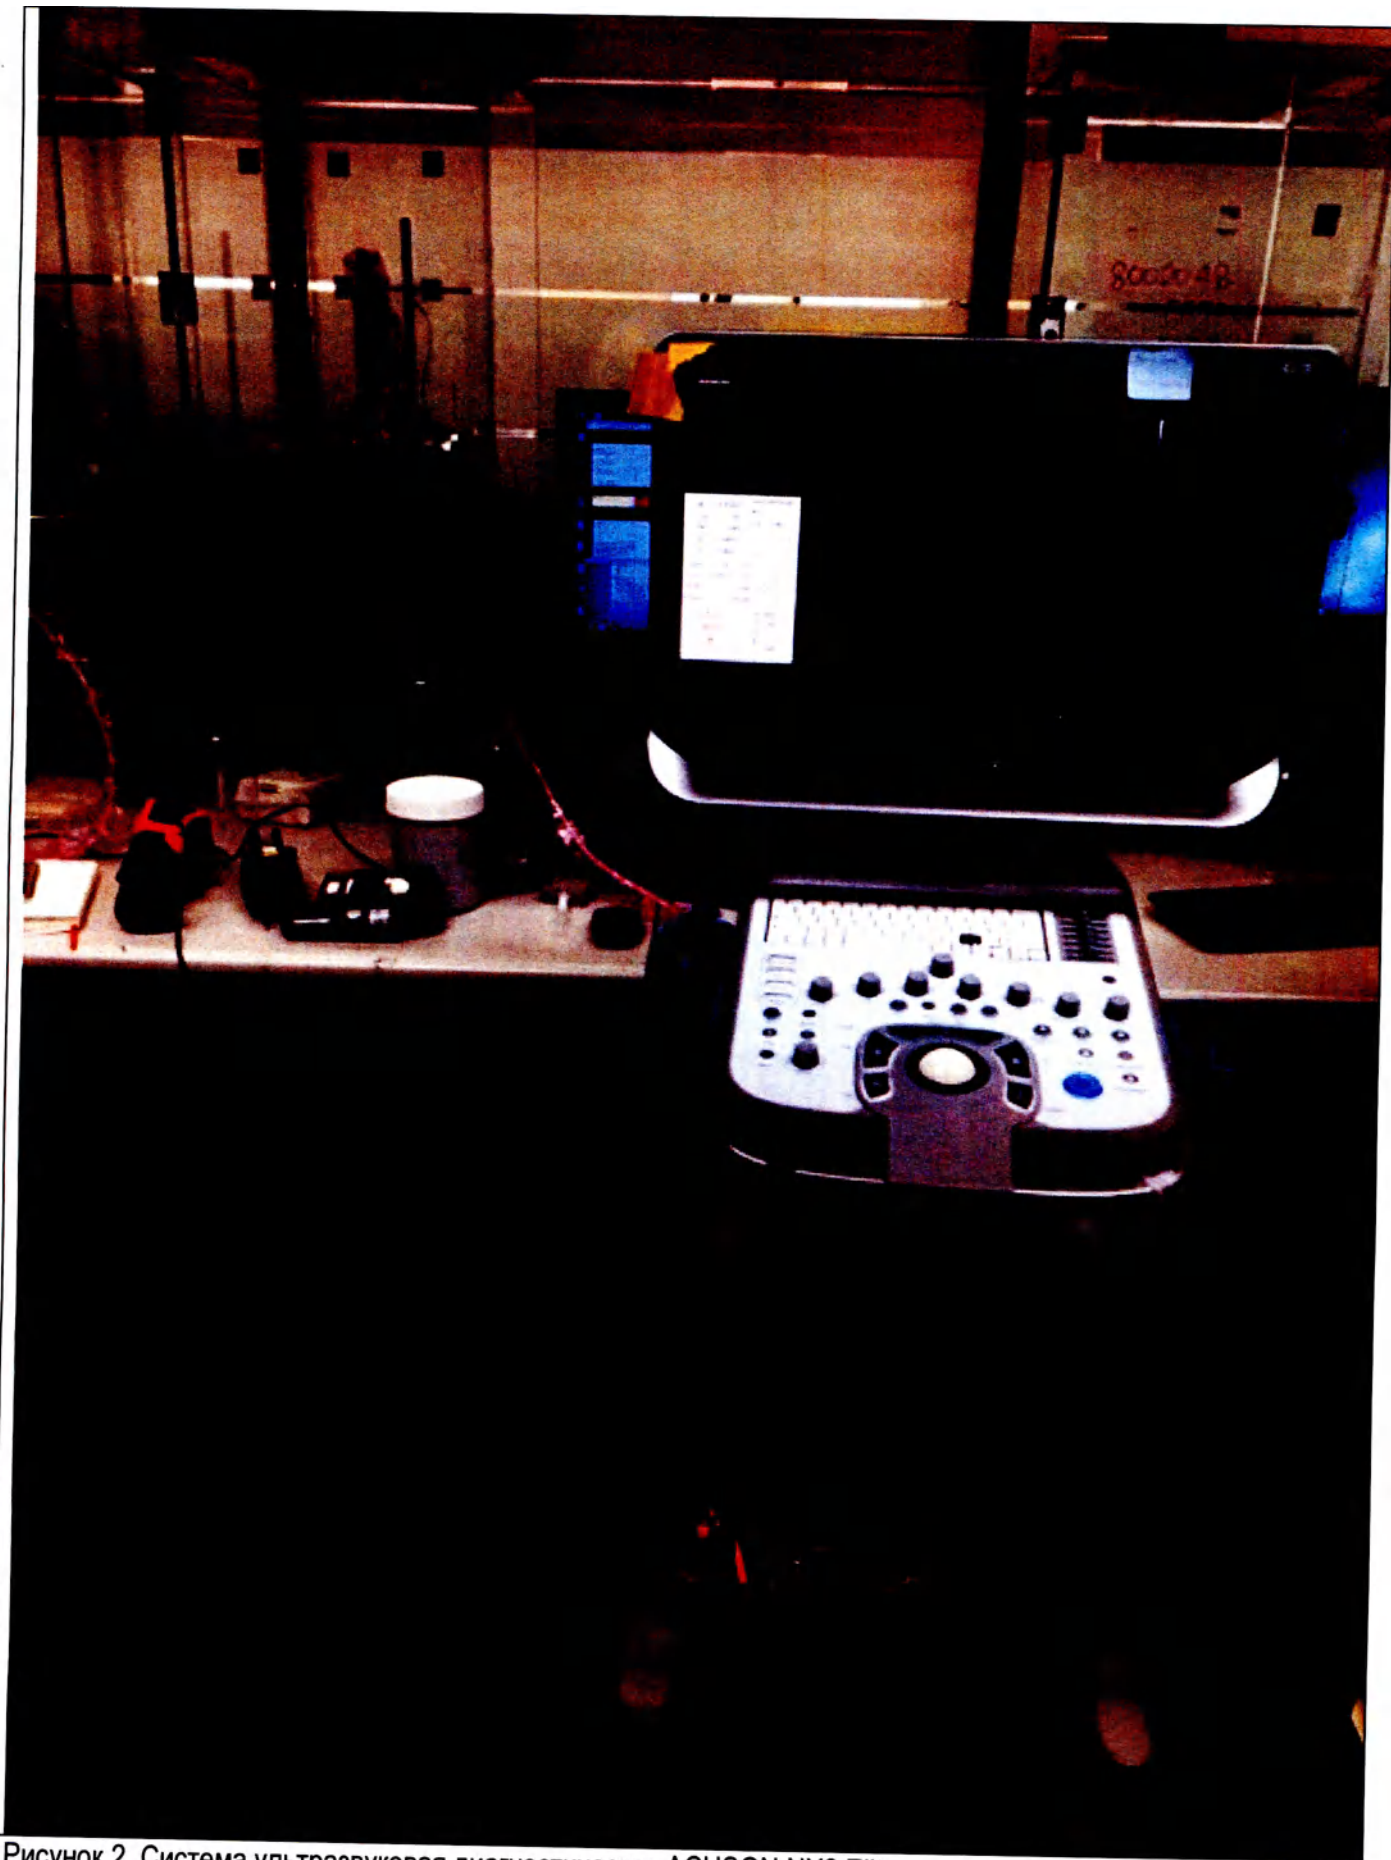


Рисунок 2. Система ультразвуковая диагностическая ACUSON NX2 Elite



Рисунок 3. Кабель электропитания



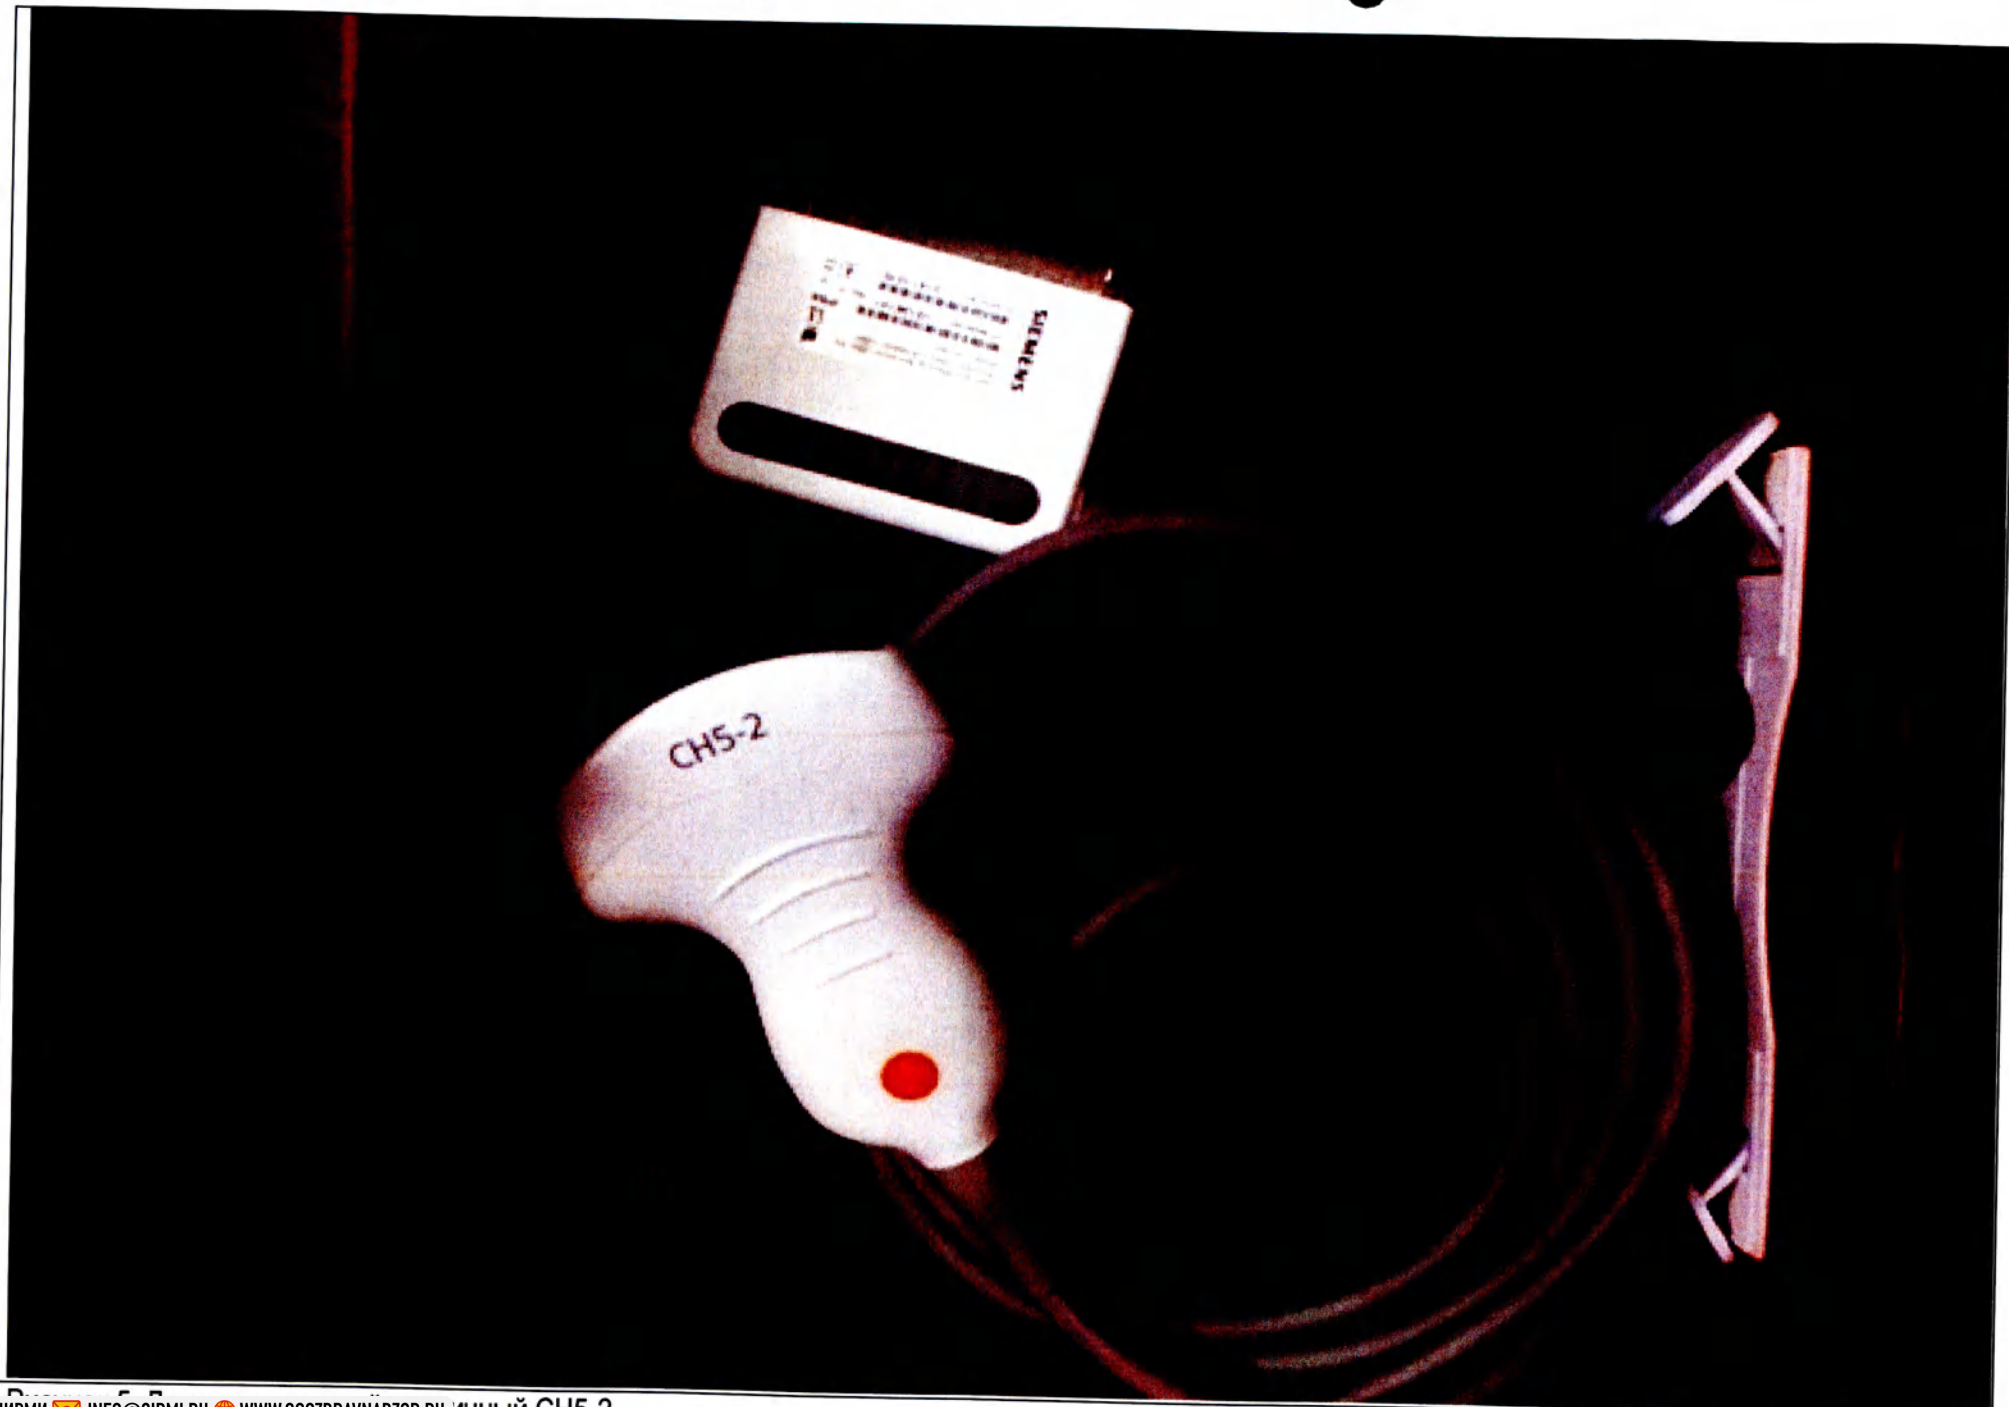




Рисунок 6. Датчик линейный матричный L10-5v



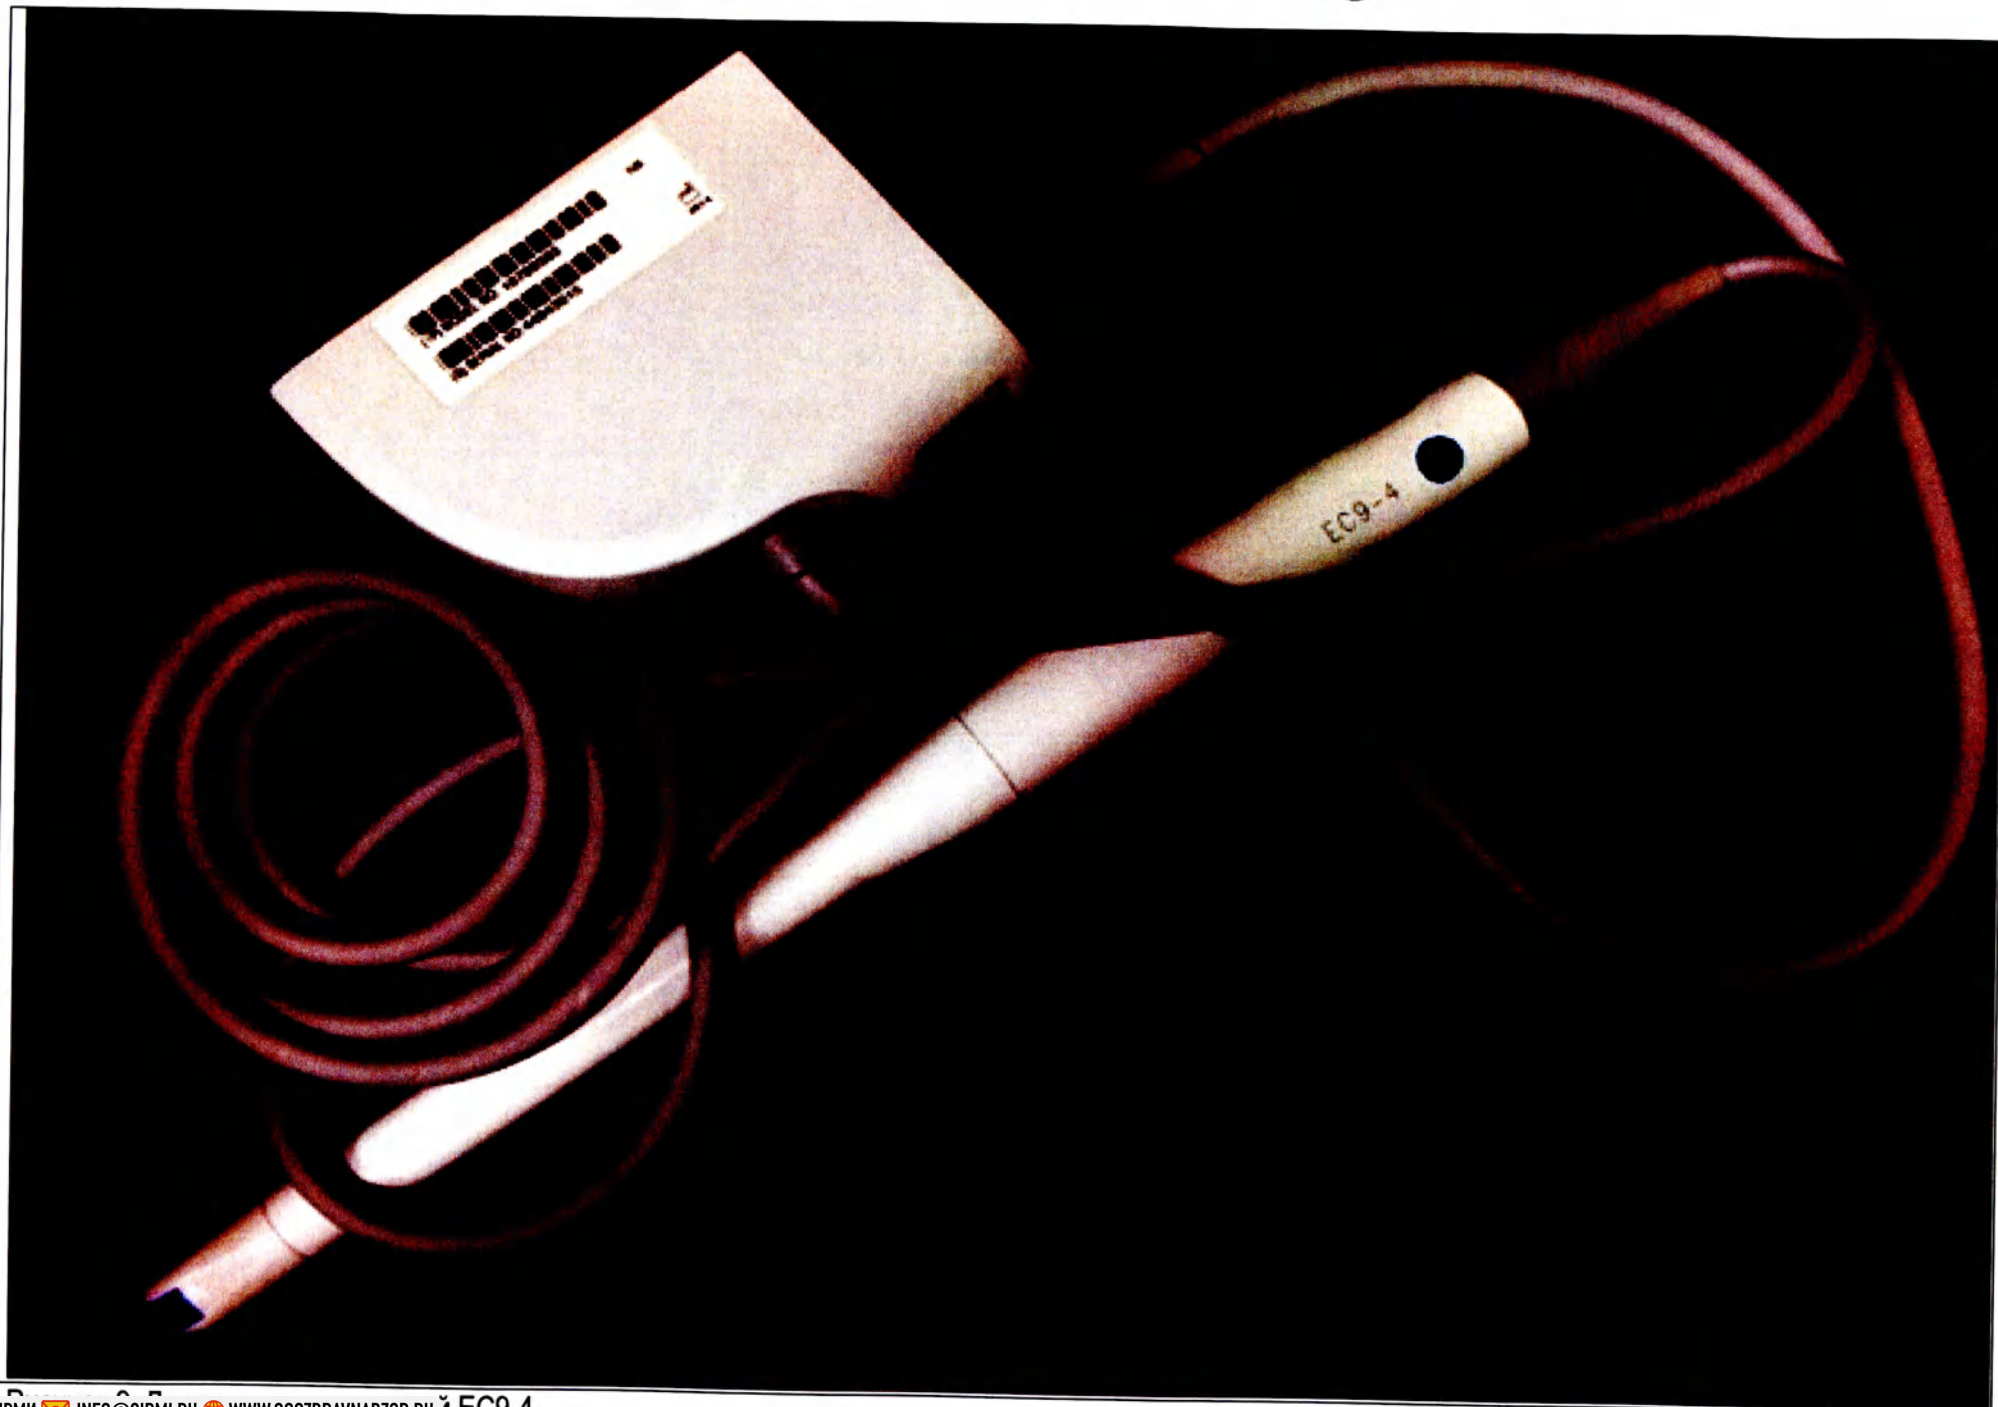




Рисунок 10. Датчик fourSight 4D конвексный с поддержкой функции четырехмерной визуализации C8F3

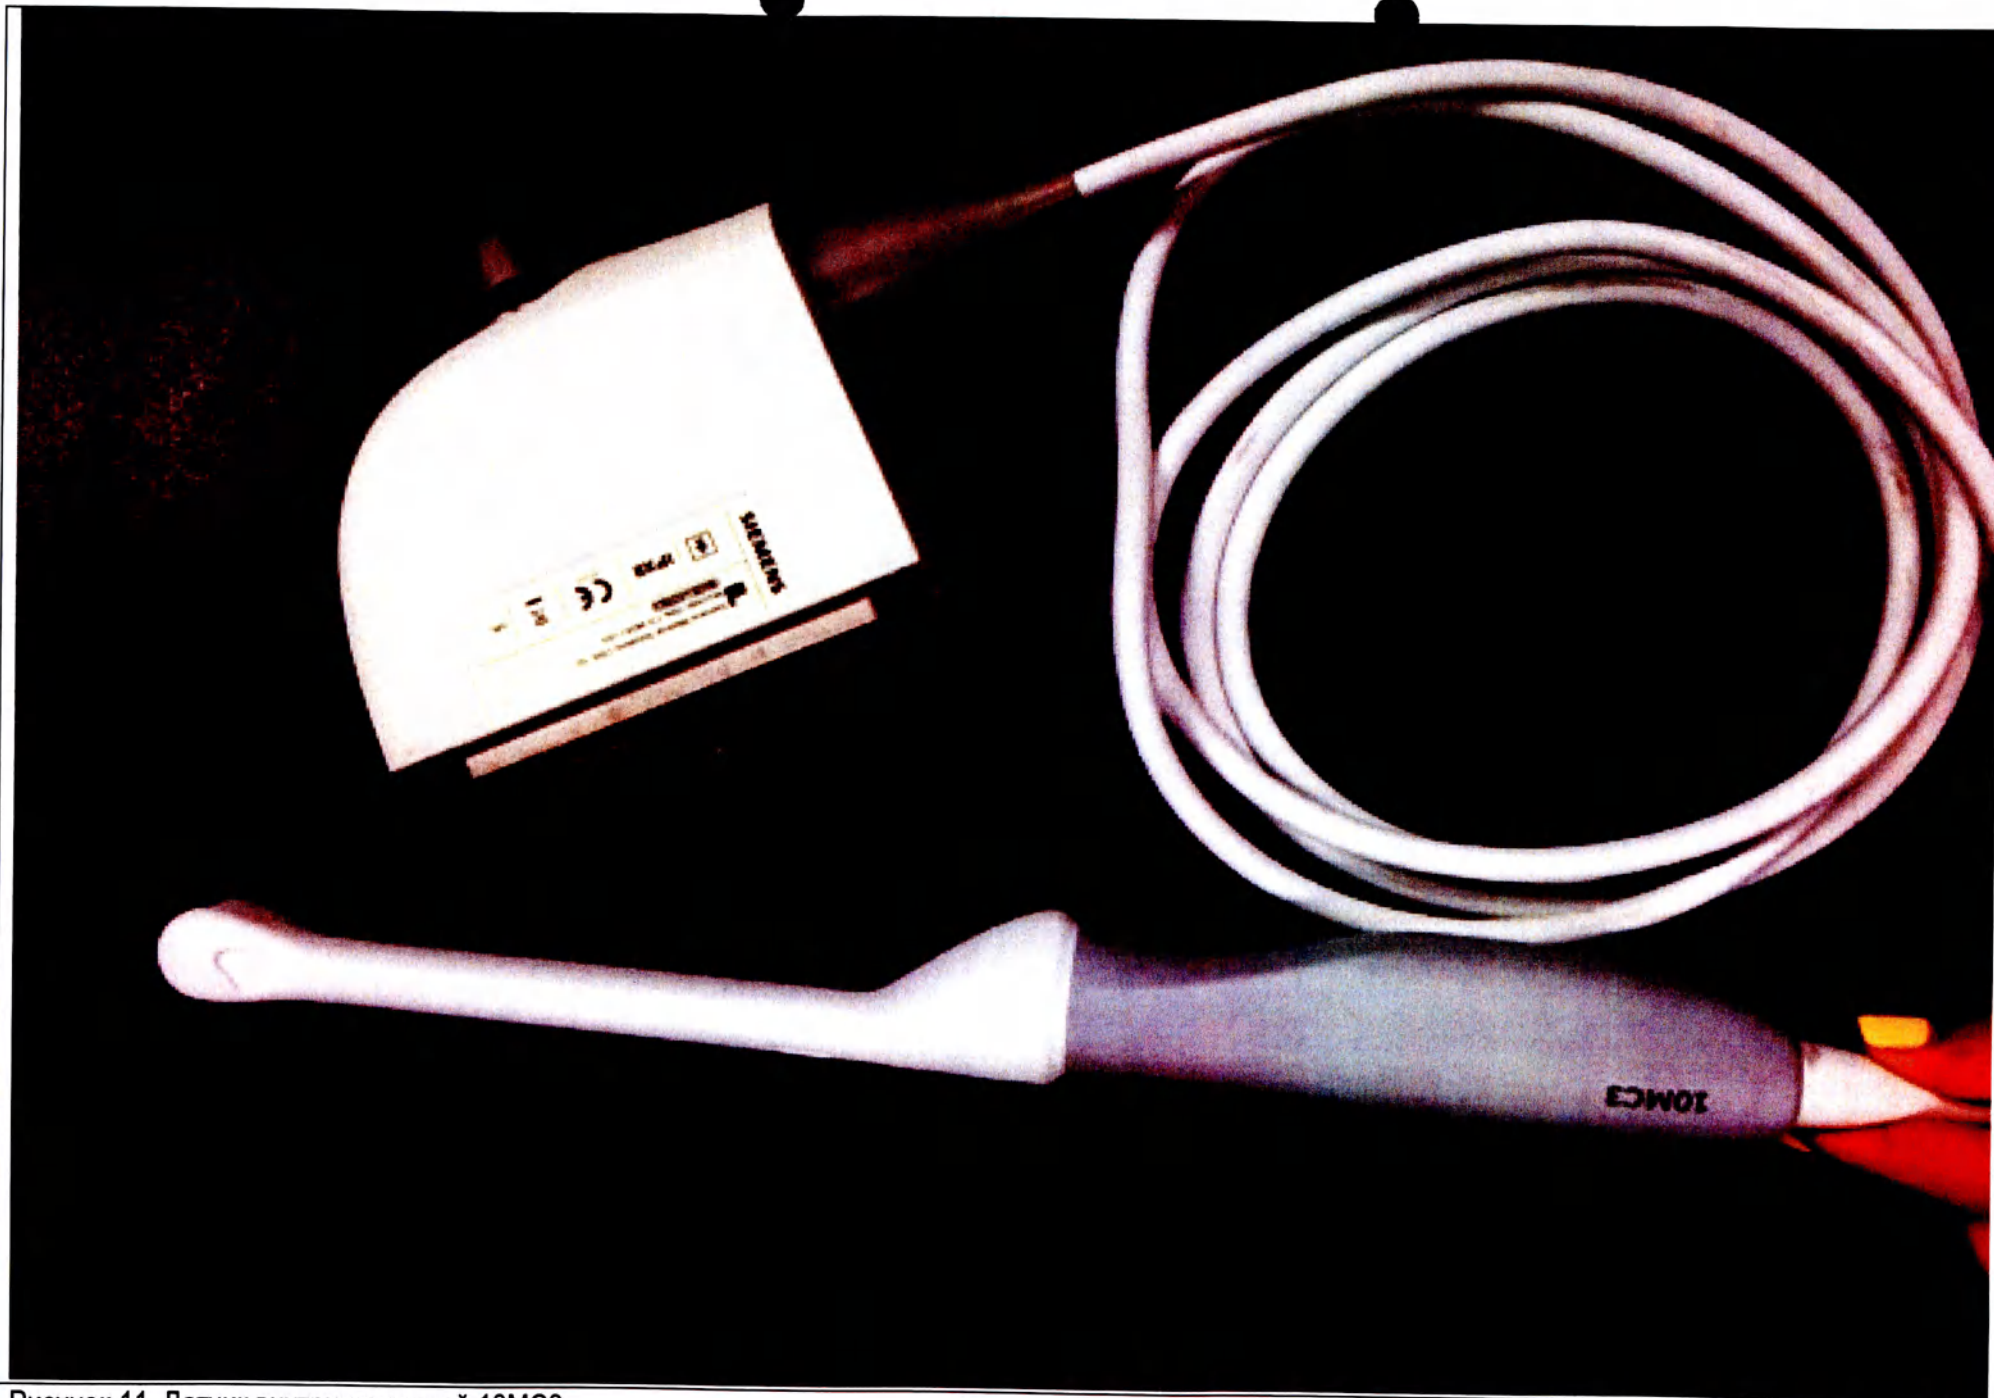
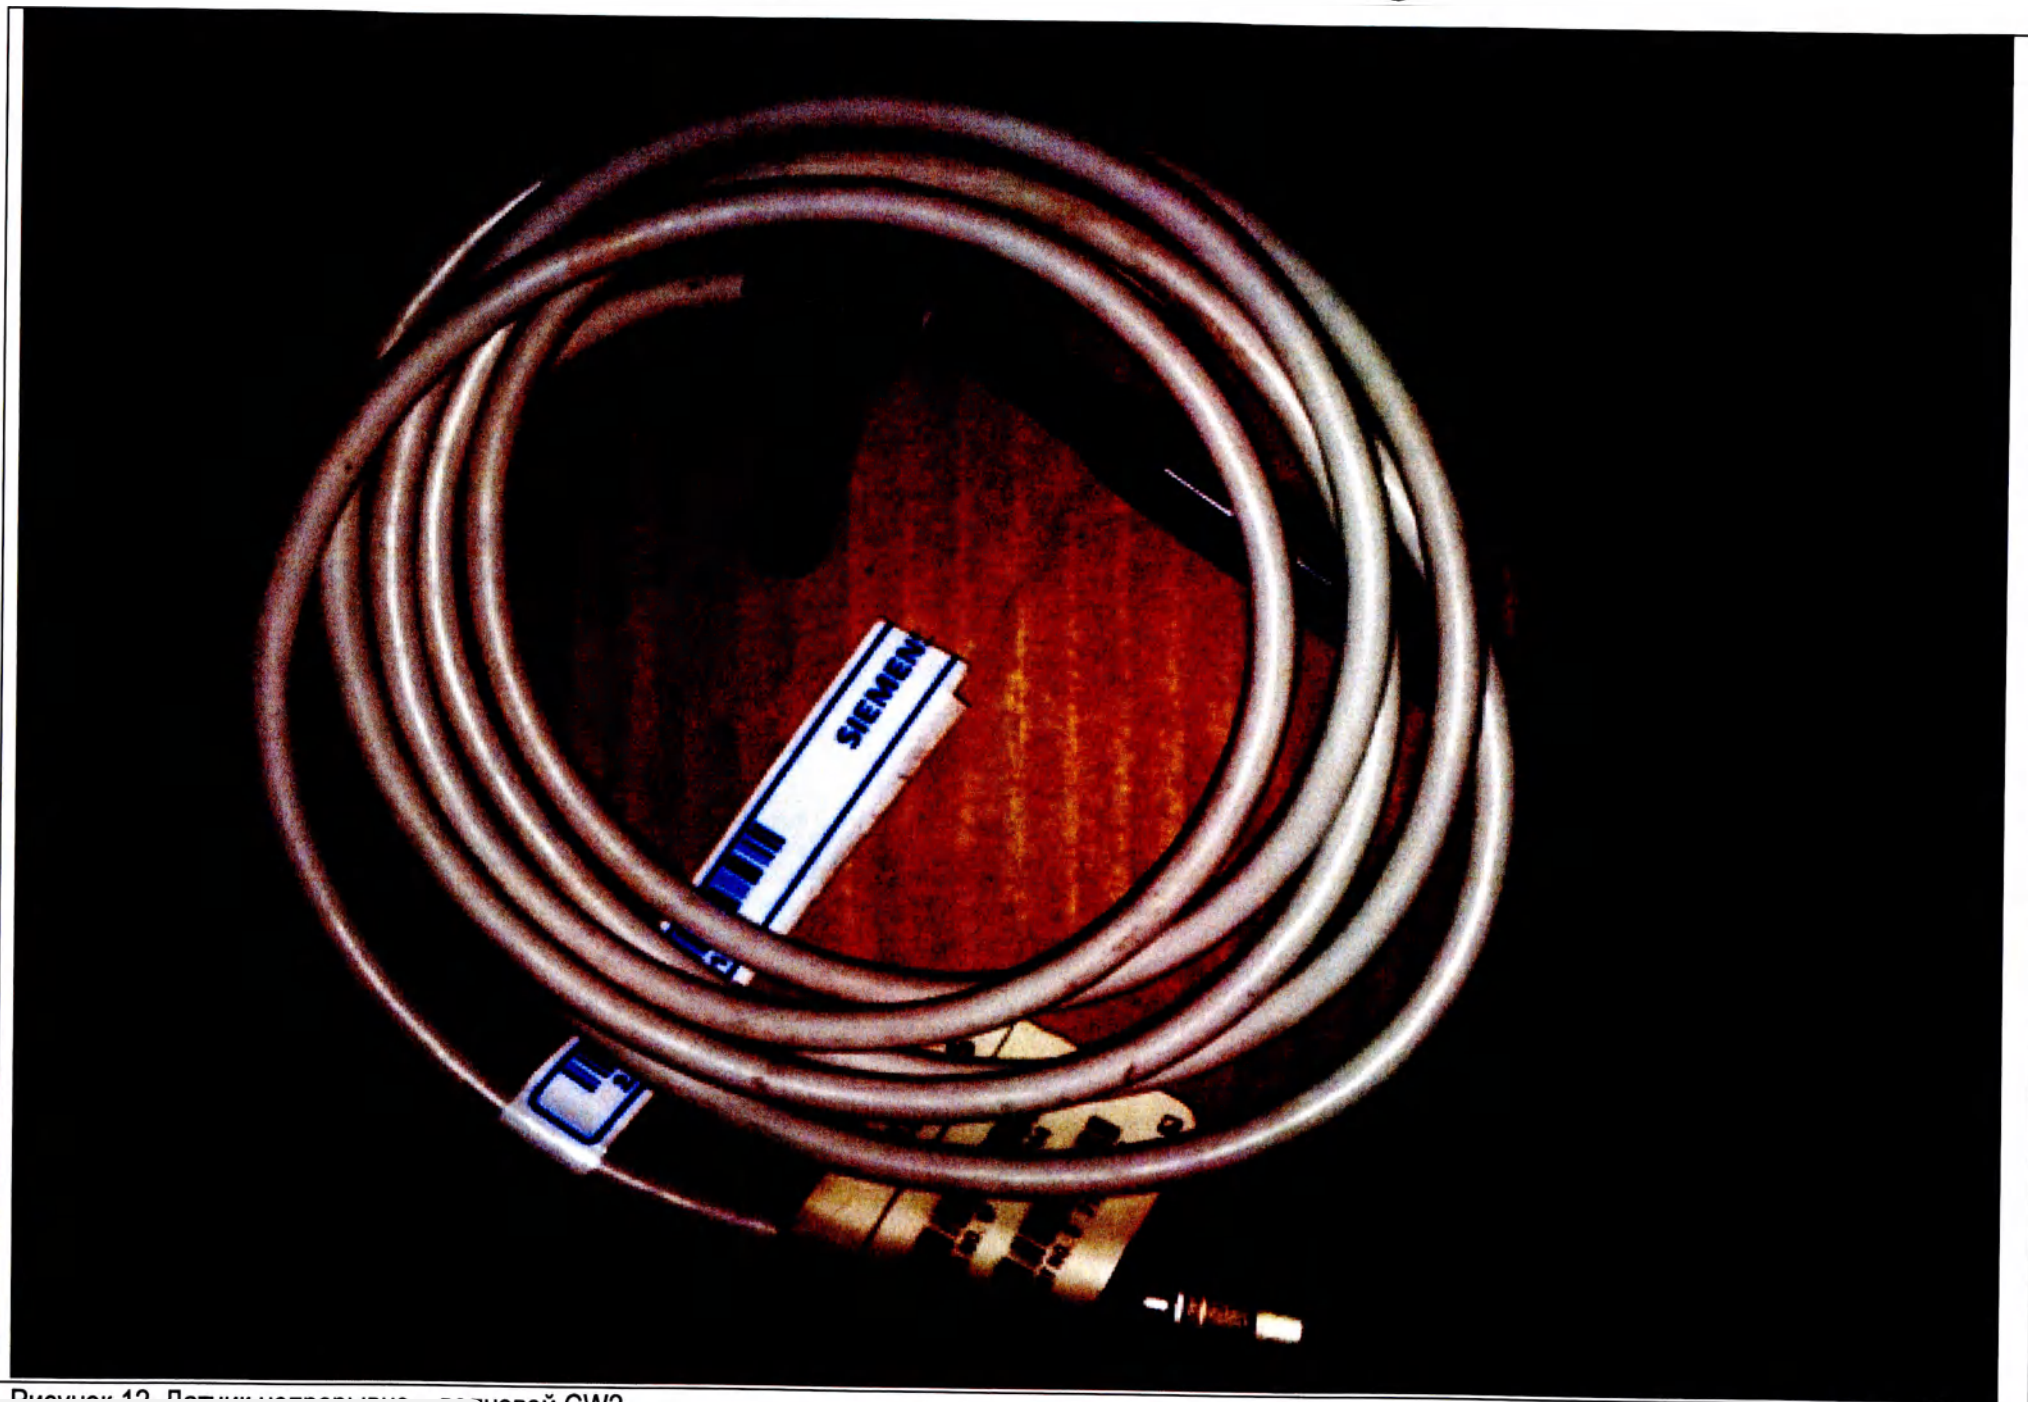


Рисунок 11. Датчик внутрисполостной 10MC3





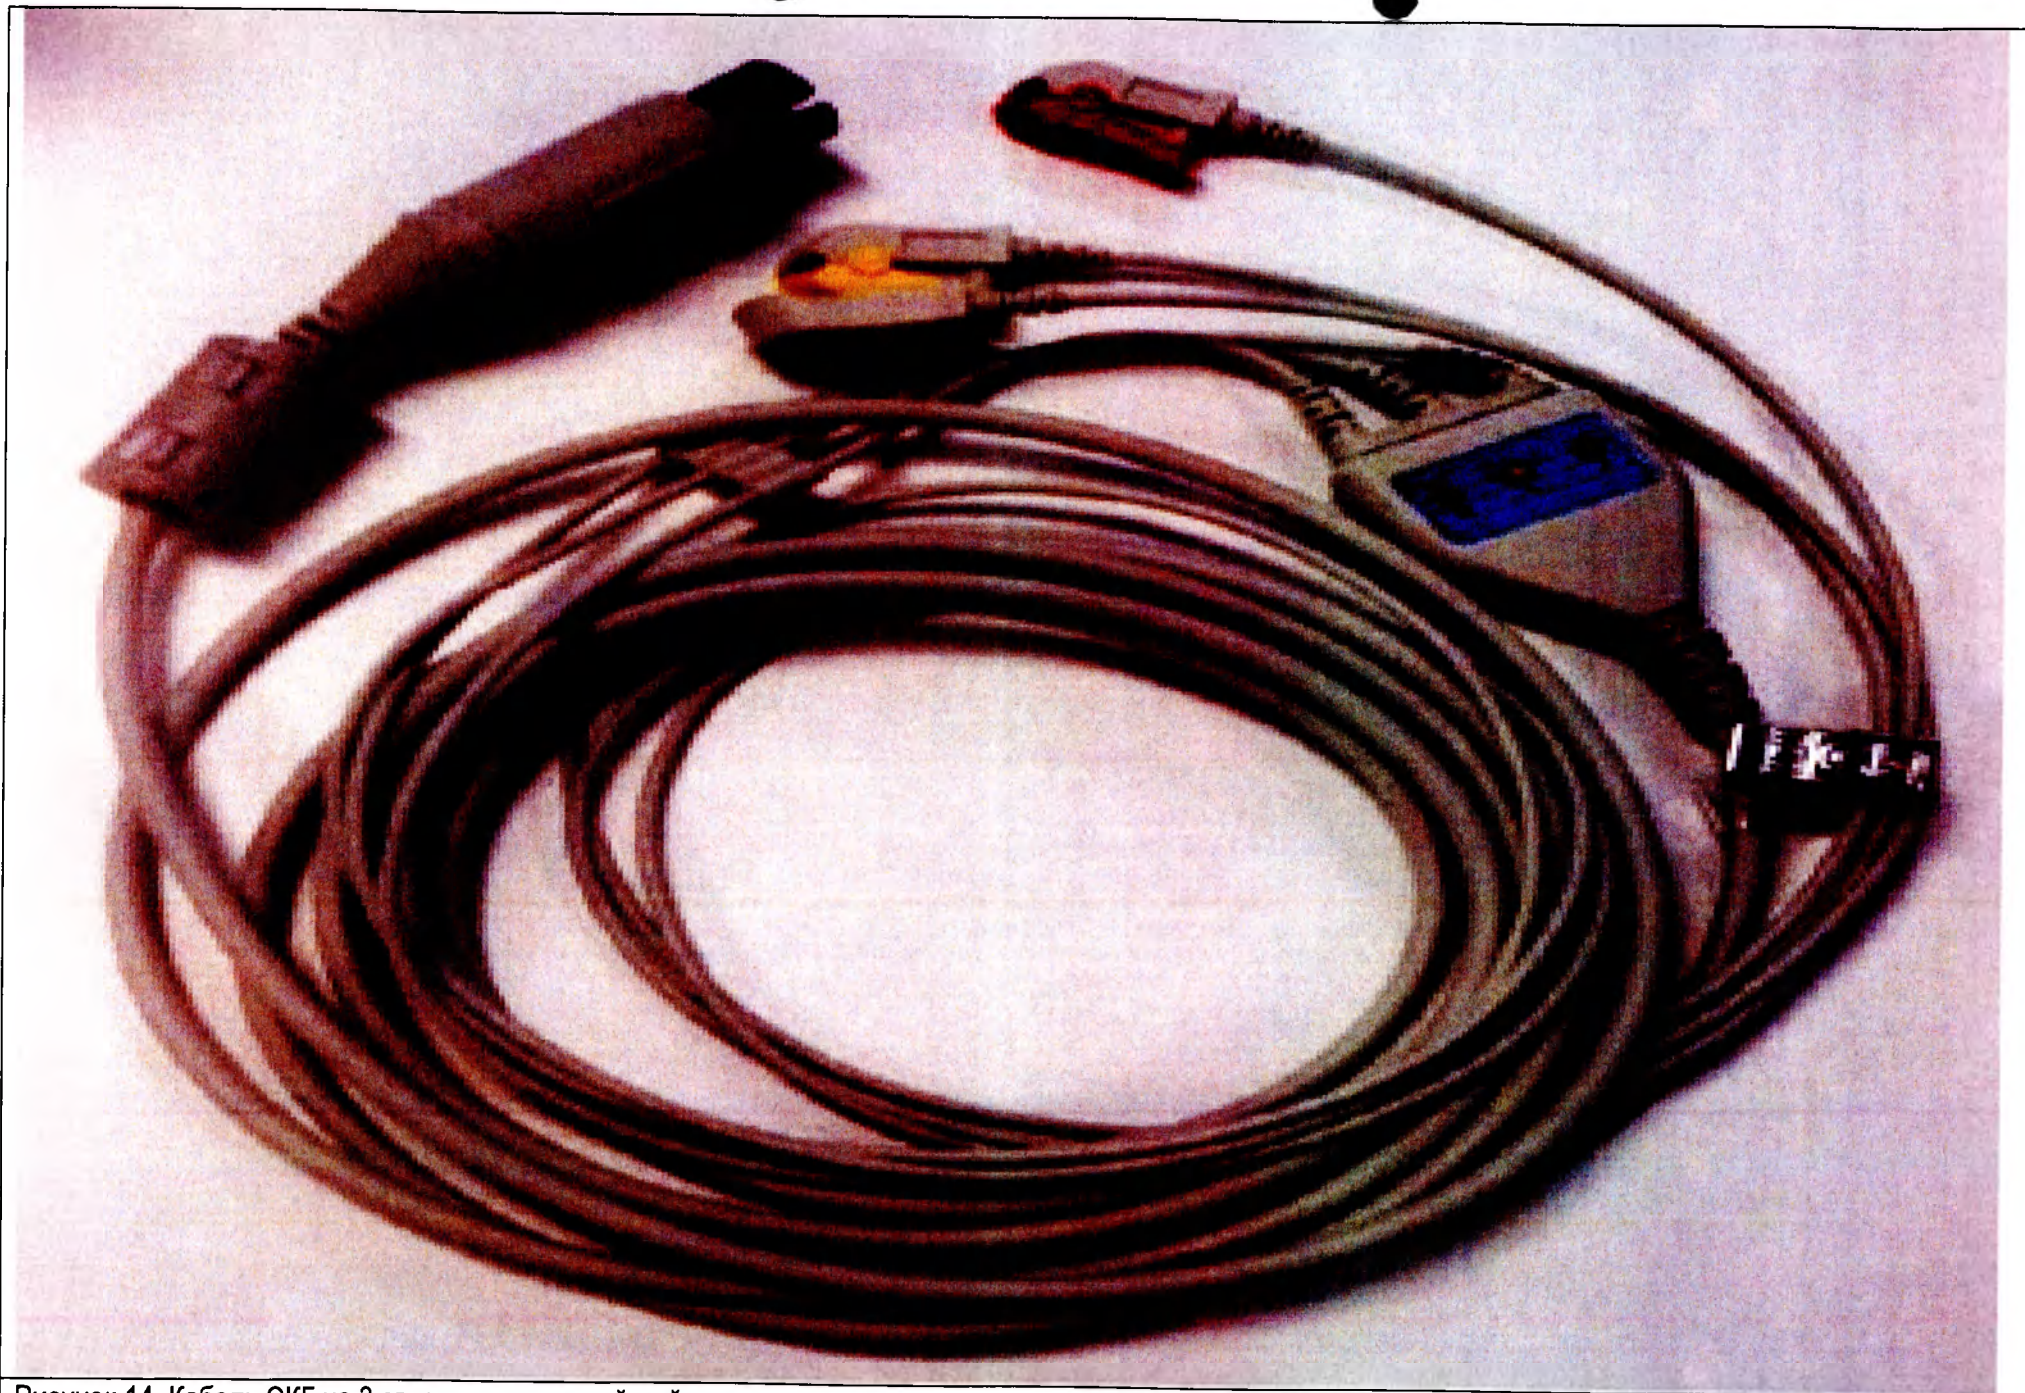


Рисунок 14. Кабель ЭКГ на 3 отведения, европейский стандарт

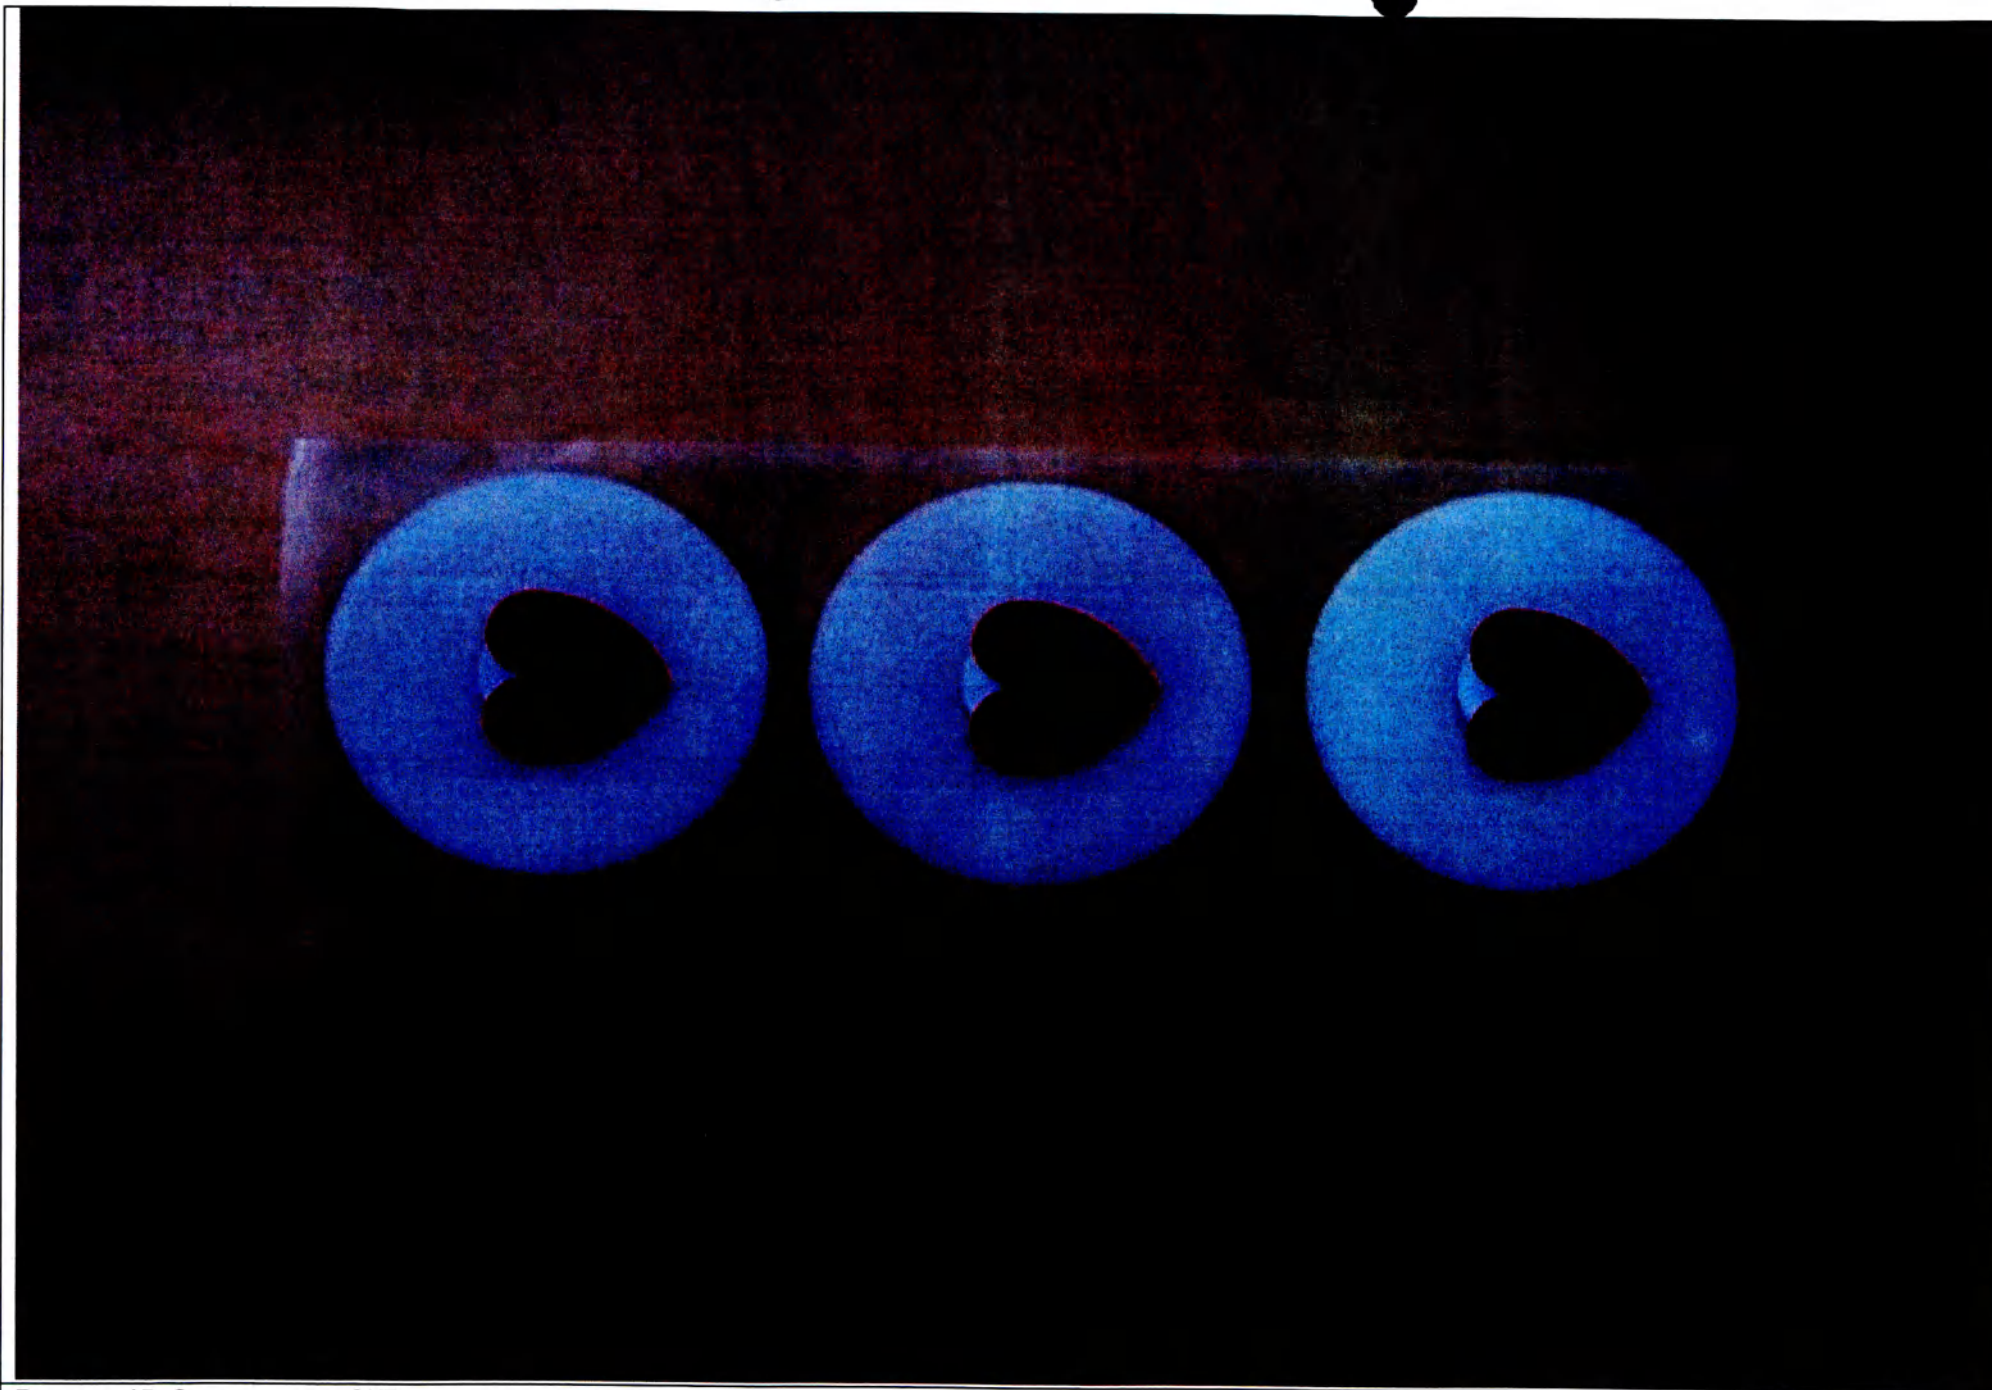


Рисунок 15. Одноразовые ЭКГ электроды

SIEMENS

Система ультразвуковая диагностическая,
варианты исполнения:

ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite с
принадлежностями

Инструкция по эксплуатации

US

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
ПРОДУКТЫ ИЛИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ
РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ, ИСПОЛНЯТЬСЯ

CE
0123

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

11361350-02


Рисунок 16. Инструкция по эксплуатации

Приложение к инструкции по эксплуатации для России

Система ультразвуковая диагностическая, варианты
исполнения: ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite
с принадлежностями

Рисунок 17. Приложение к Инструкции по эксплуатации для России.

Фотографические изображения принадлежностей медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2»

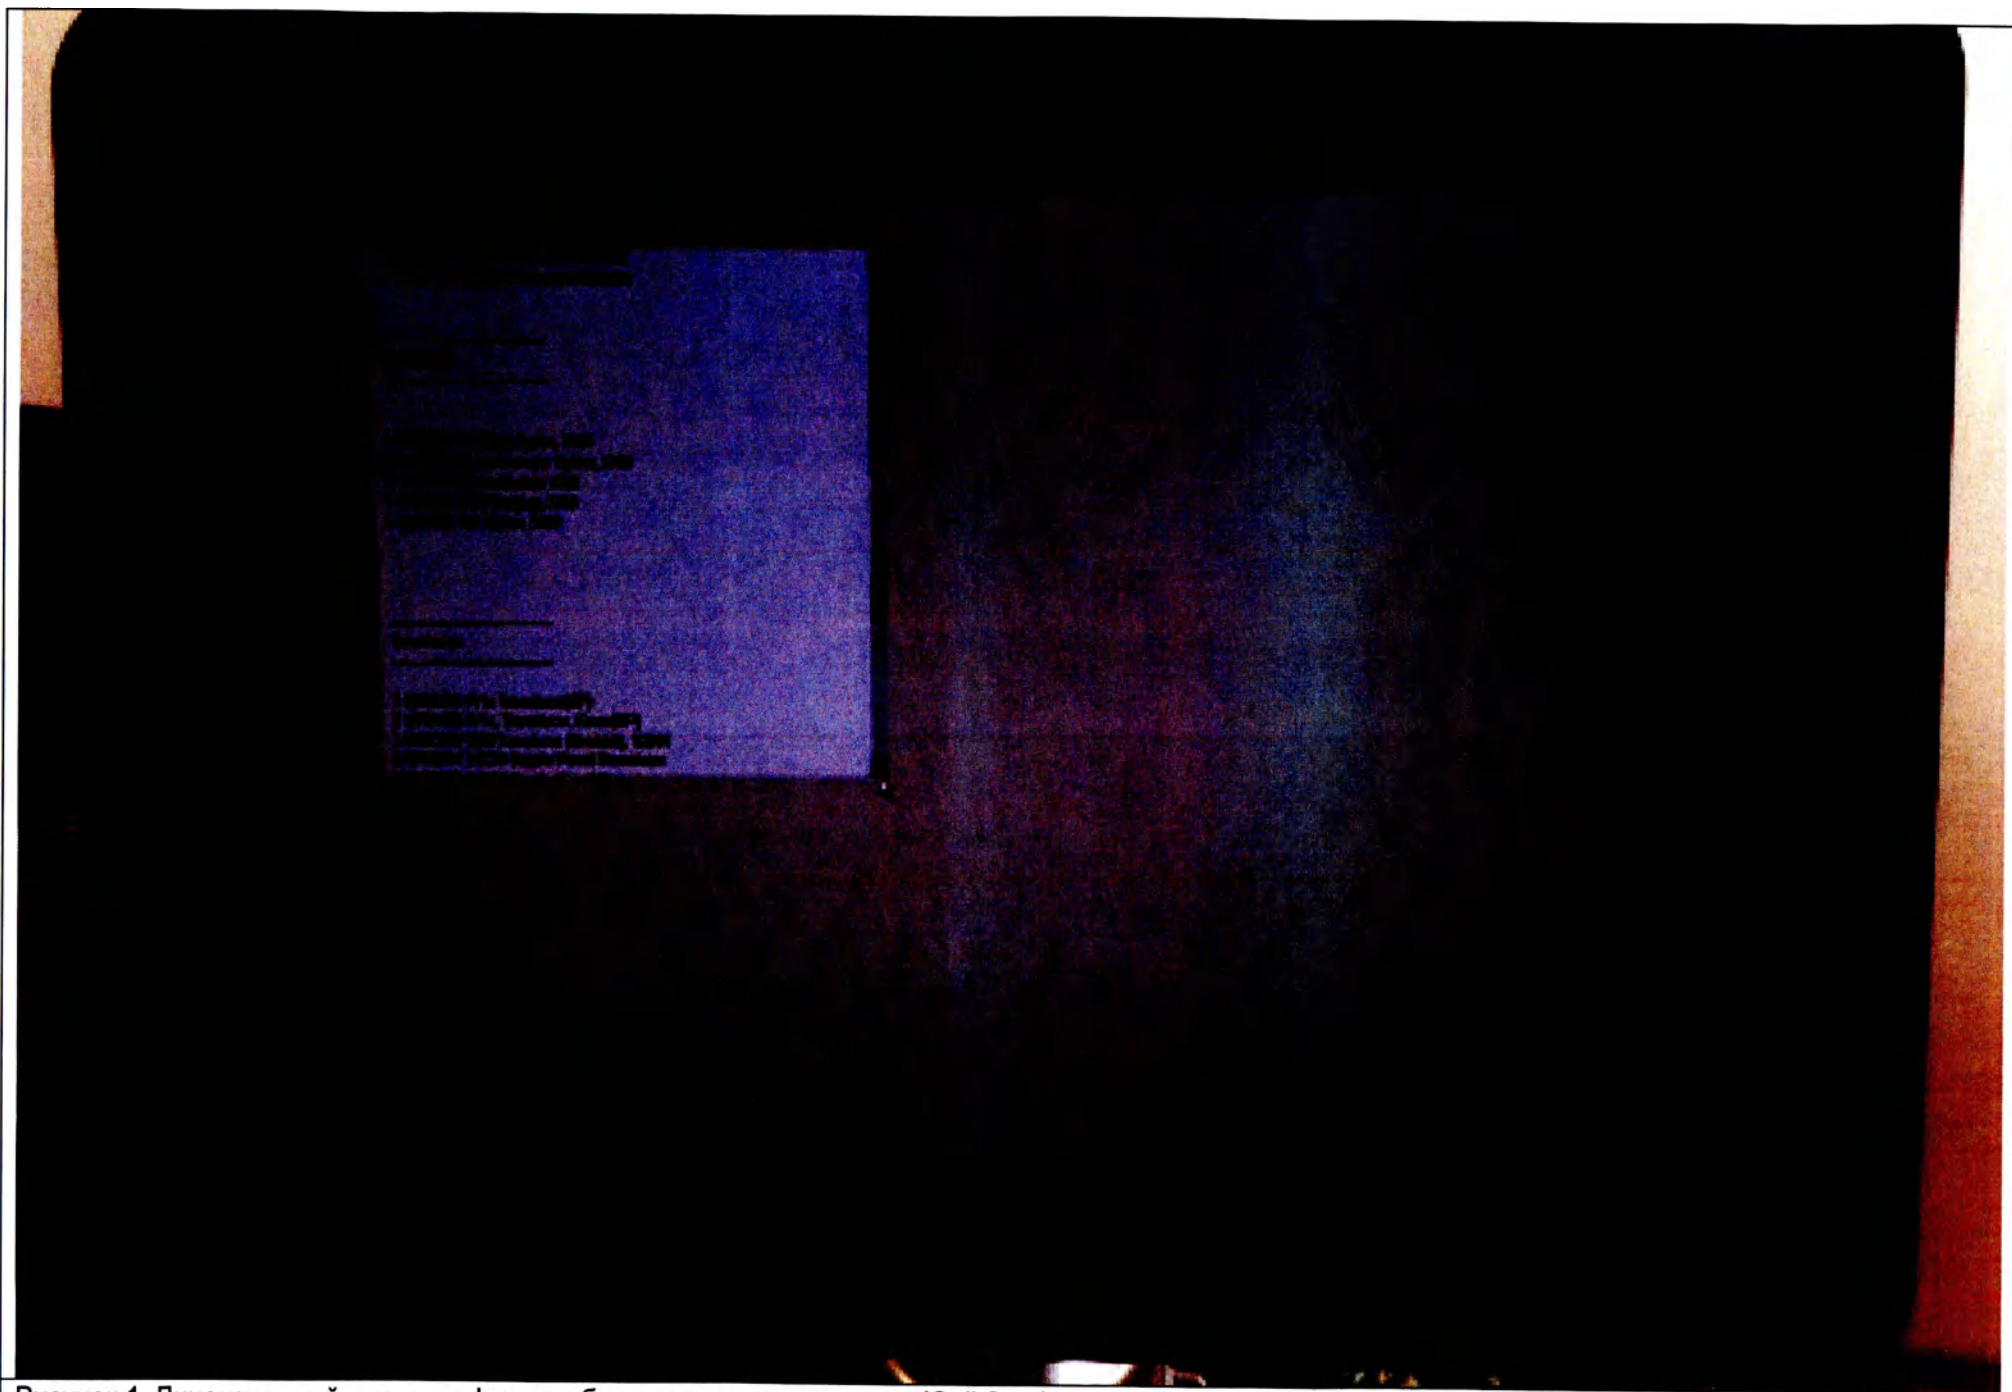

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM**
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Local Host ☒ Show network status

Alias: Default

☒ Default

AE Title: Default

Host Name: Default

MAC Address: 00-19-0F-23-2C-DE

New

Edit

Delete

☐ DHCP

☐ Mapping Application

☒ Fixed IP address

IP Address: 192 168 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 0 0 0 0

Media Type

HardwareDefault

Duplex Mode

HardwareDefault

Save

Cancel

Рисунок 2. Лицензионный ключ для функции передачи данных по стандарту DICOM (передача данных на хранение в сеть, отправка и запрос рабочих списков DICOM отправка и запрос процедур для пациента из информационной сети учреждения DICOM MPPS) на оптическом и/или электронном носителе.

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Storage Server ☐ Uses Commitment☒ SS_AL

Alias:

SS_AL

AE Title:

SS_AE

IP Address:

192

168

0

3

Port Number:

5104

Ping and Echo Timeout in seconds:

10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM☐ Store During Exam☒ Store At End Of Exam☐ After Every Image is Stored☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure:

2

Seconds Between Each Retry:

60

Write Timeout in Seconds:

30

Connect Timeout in Seconds:

30

Image Format:

Automatic

☒ Send SR☒ No Monochrome conversion☐ Store all images as Monochrome☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Storage Server ☐ Uses Commitment

Alias: SS_AL

AE Title: SS_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM

☐ Store During Exam

☐ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored

☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure:

2

Seconds Between Each Retry:

60

Write Timeout in Seconds:

30

Connect Timeout in Seconds:

30

Image Format: Automatic

☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

Рисунок 4. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для кардиологических исследований на оптическом и/или электронном носителе.

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Storage Server ☐ Uses Commitment

☒ SS_AL

Alias:

SS_AL

AE Title:

SS_AE

IP Address:

192 168 0 3

Port Number:

5104

Ping and Echo Timeout in seconds:

10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM

☐ Store During Exam

☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored

☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure:

2

Seconds Between Each Retry:

60

Write Timeout in Seconds:

60

Connect Timeout in Seconds:

30

Image Format:

Automatic

☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

Рисунок 5. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для сосудистых исследований на оптическом и/или электронном носителе.

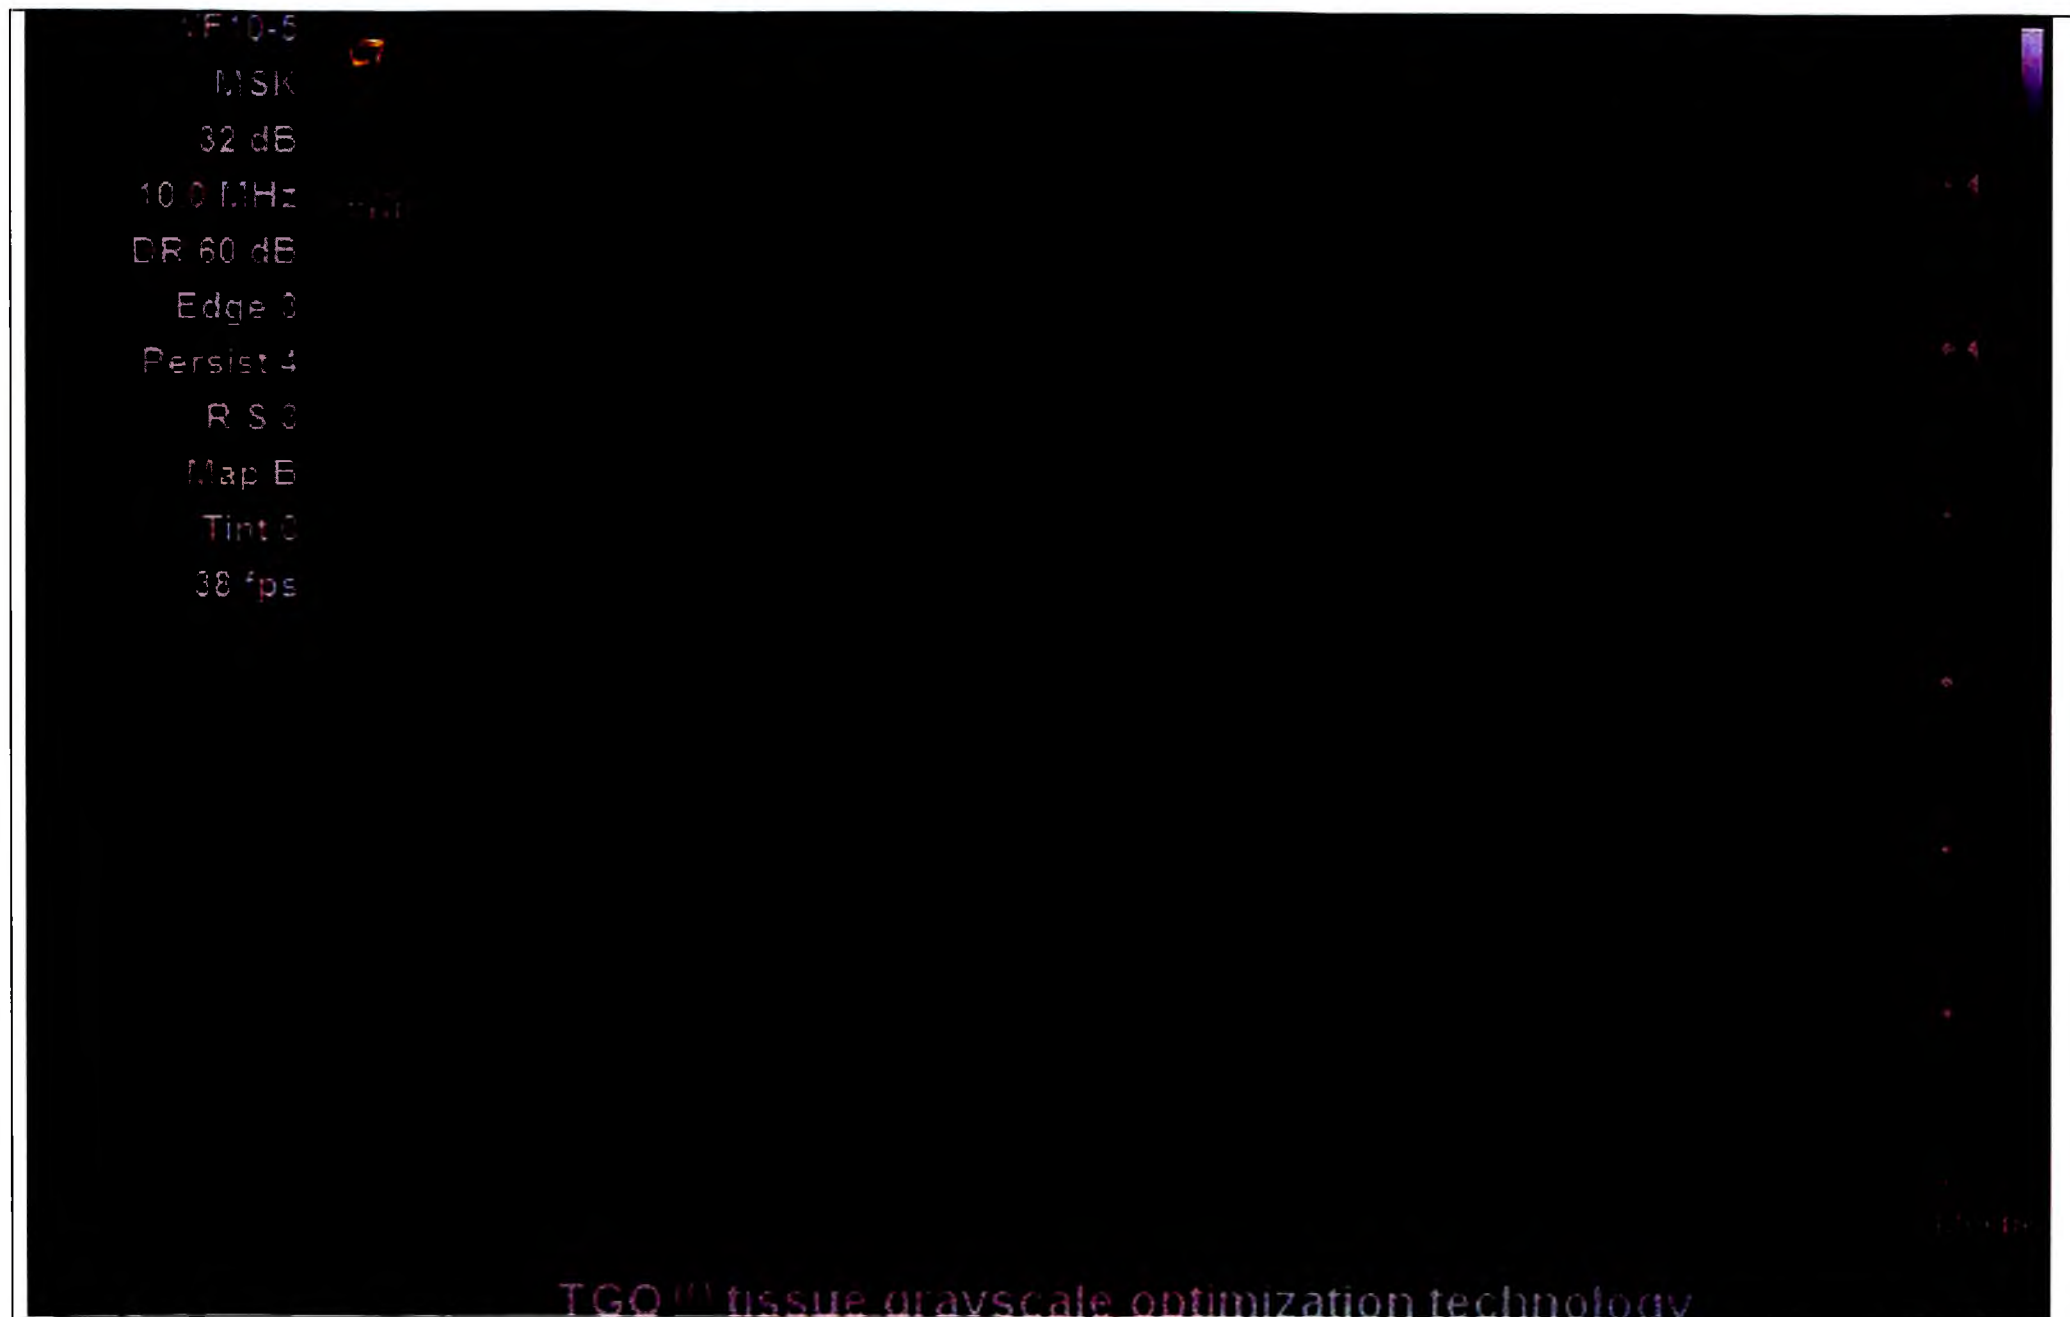


Рисунок 6. Лицензионный ключ для технологии оптимизации оттенков серого (TGO) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 7. Лицензионный ключ для технологии тканевой гармоник (THI) на оптическом и/или электронном носителе.

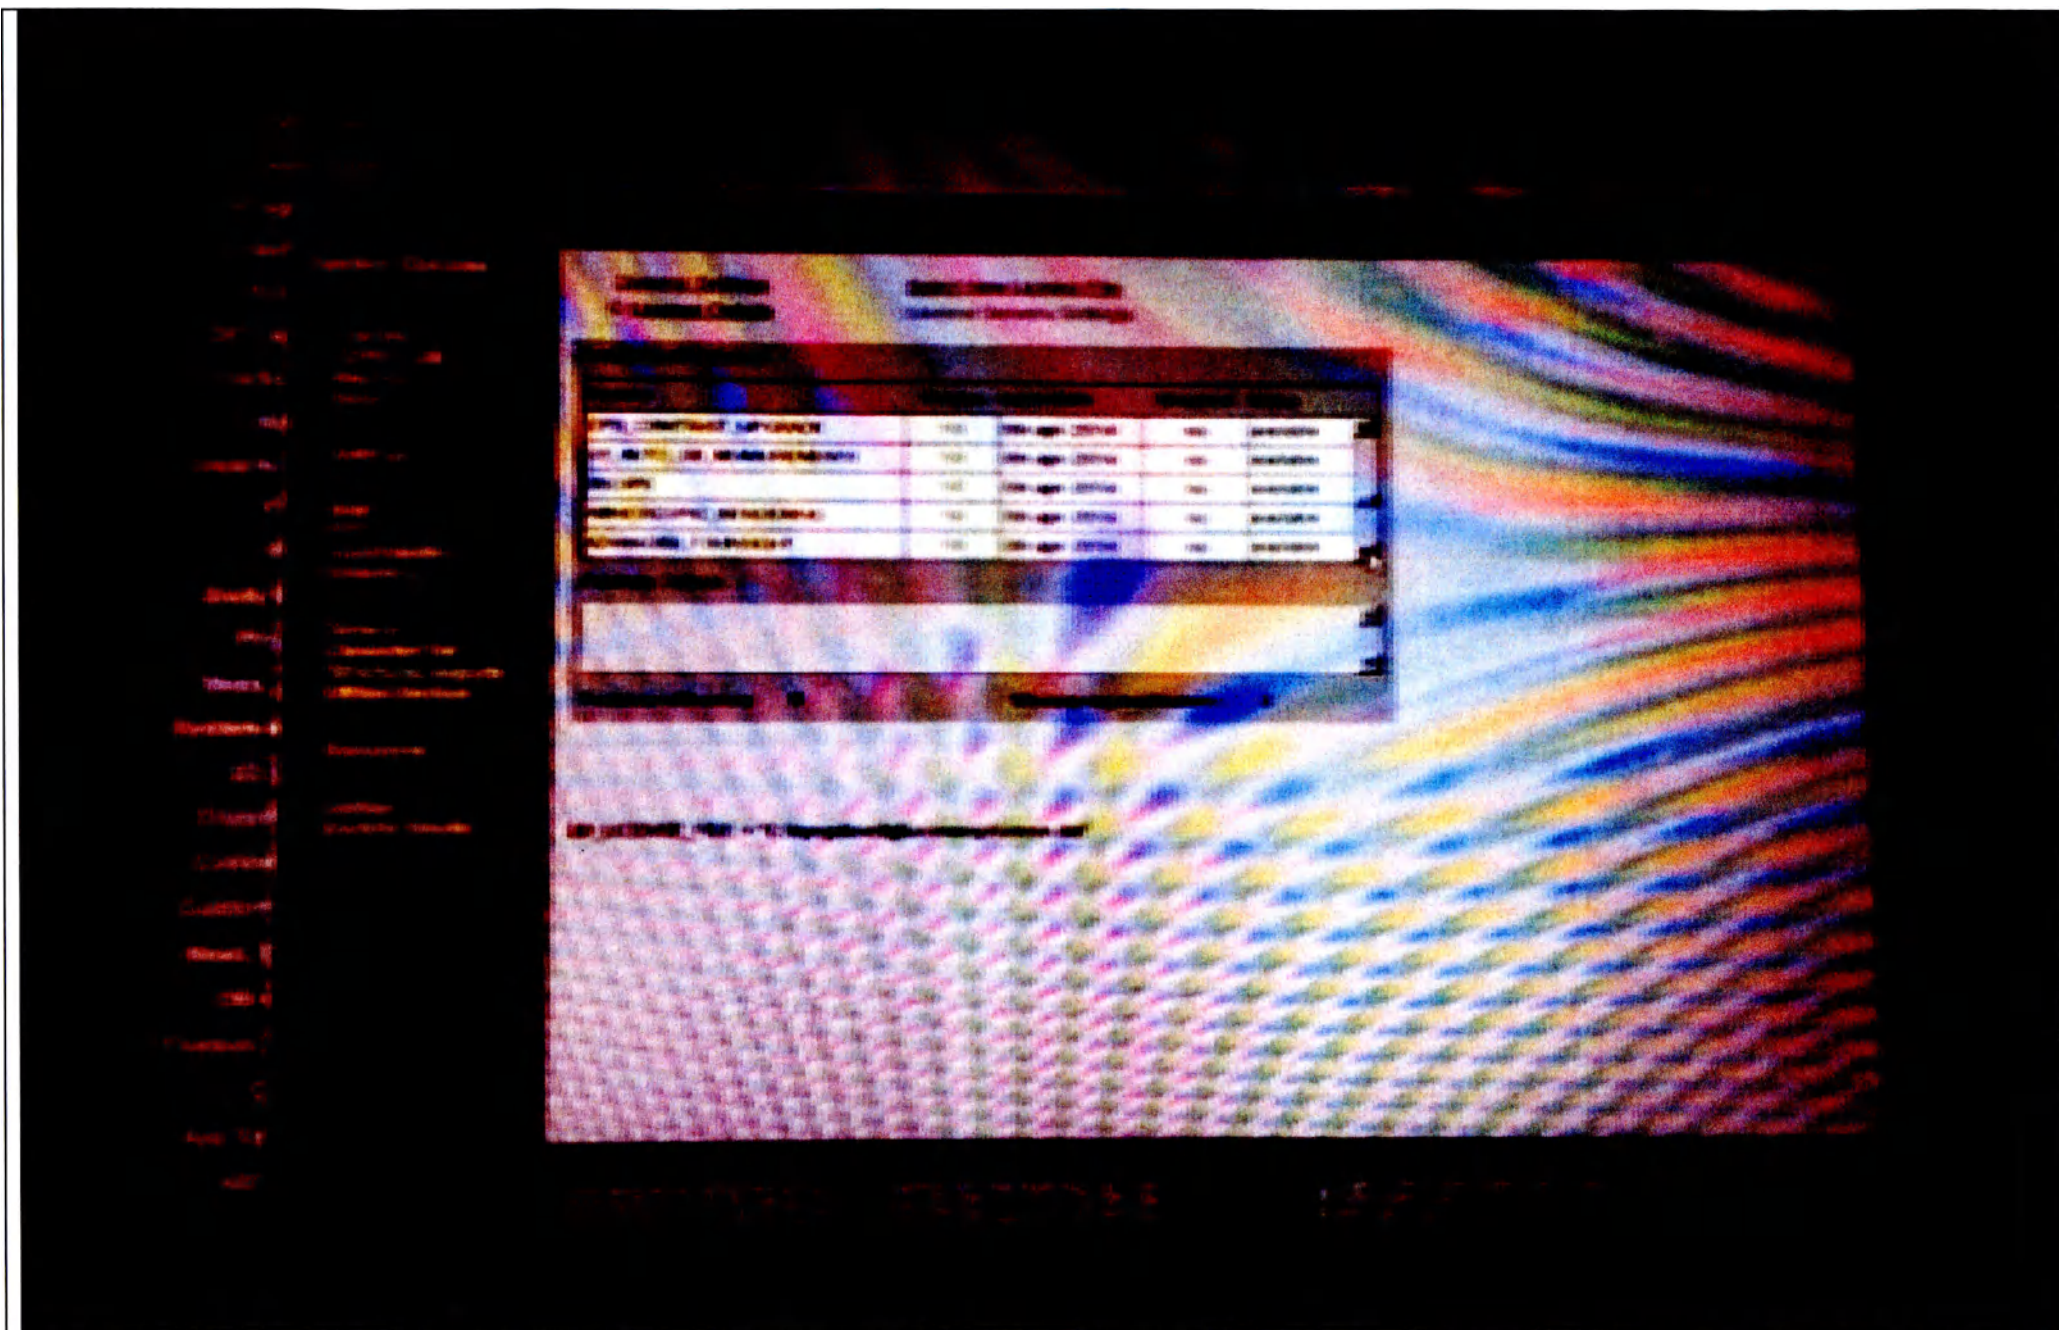


Рисунок 8. Лицензионный ключ для функции автоматических перинатальных исследований (syngo Auto OB) на оптическом и/или электронном носителе.

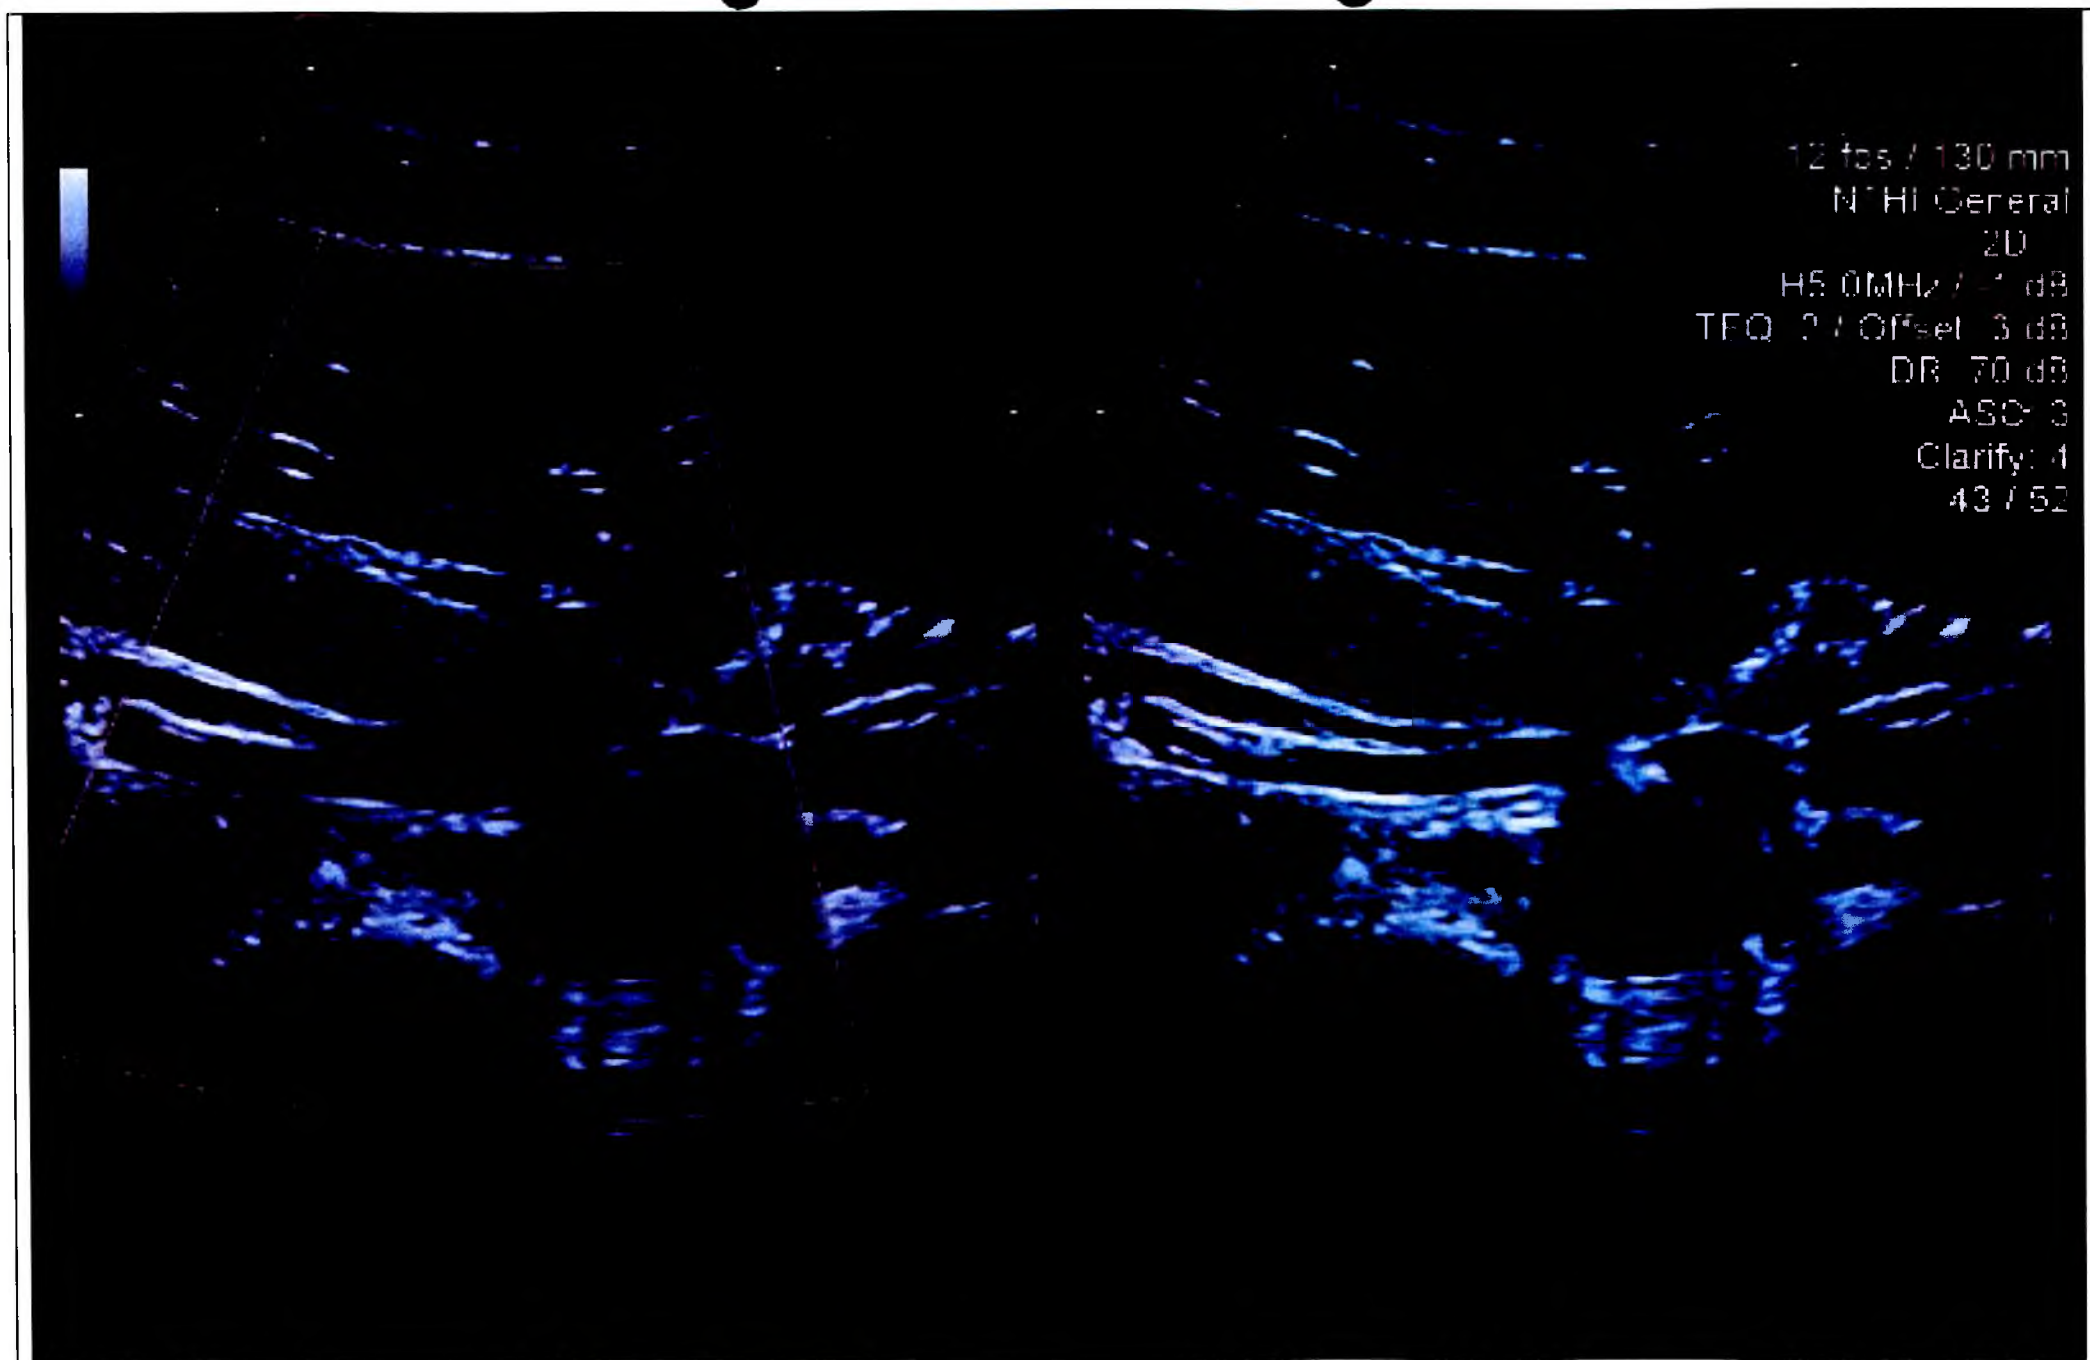


Рисунок 9. Лицензионный ключ для функции повышения качества отображения сосудов (Clarify VE) на оптическом и/или электронном носителе.

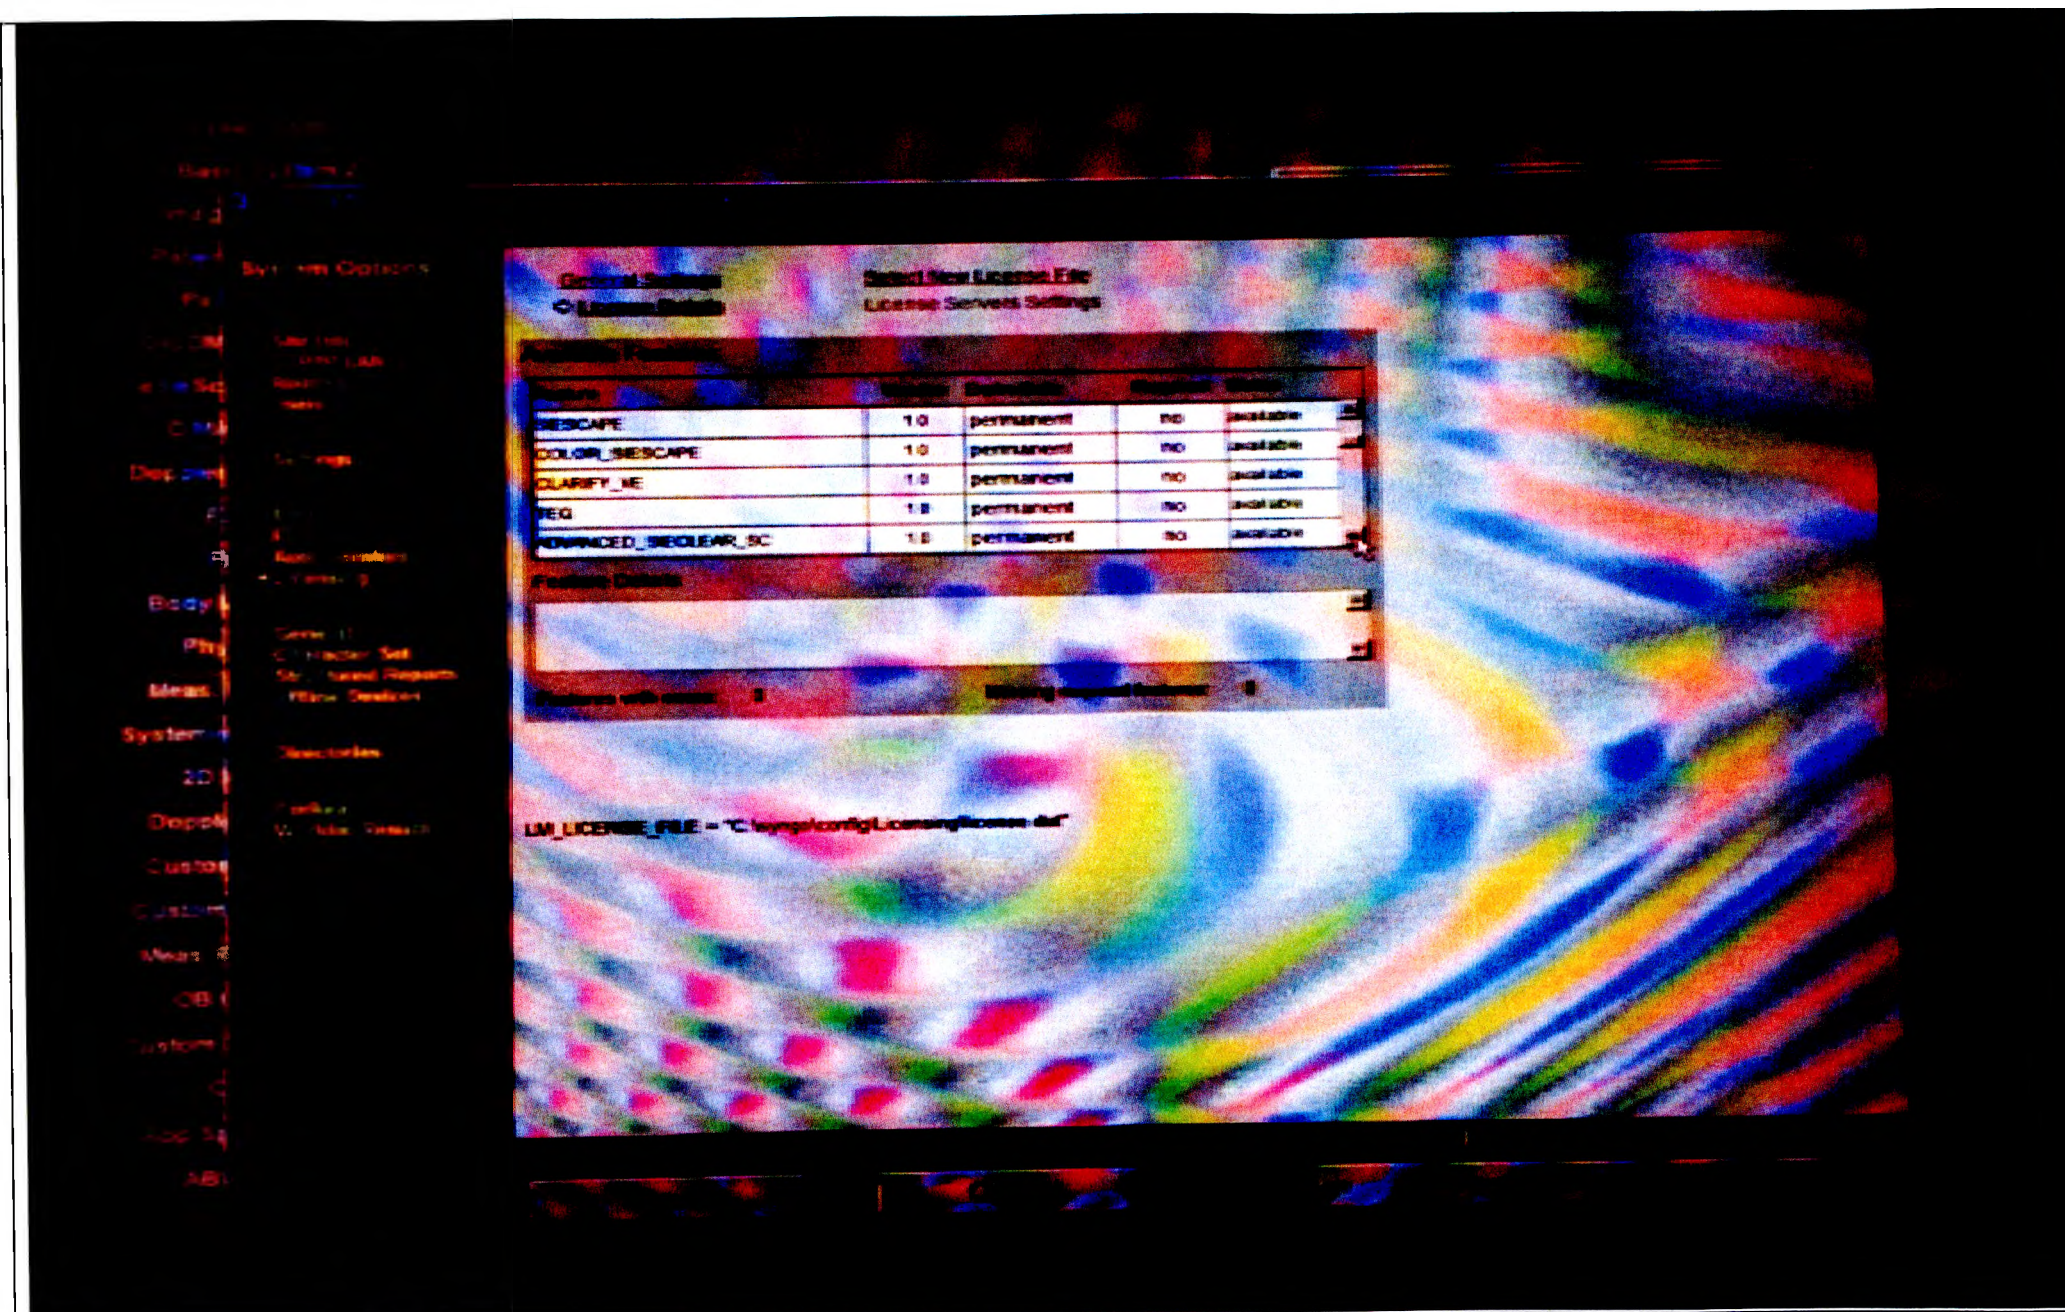


Рисунок 10. Лицензионный ключ для функции панорамной визуализации (SieScape) на оптическом и/или электронном носителе.

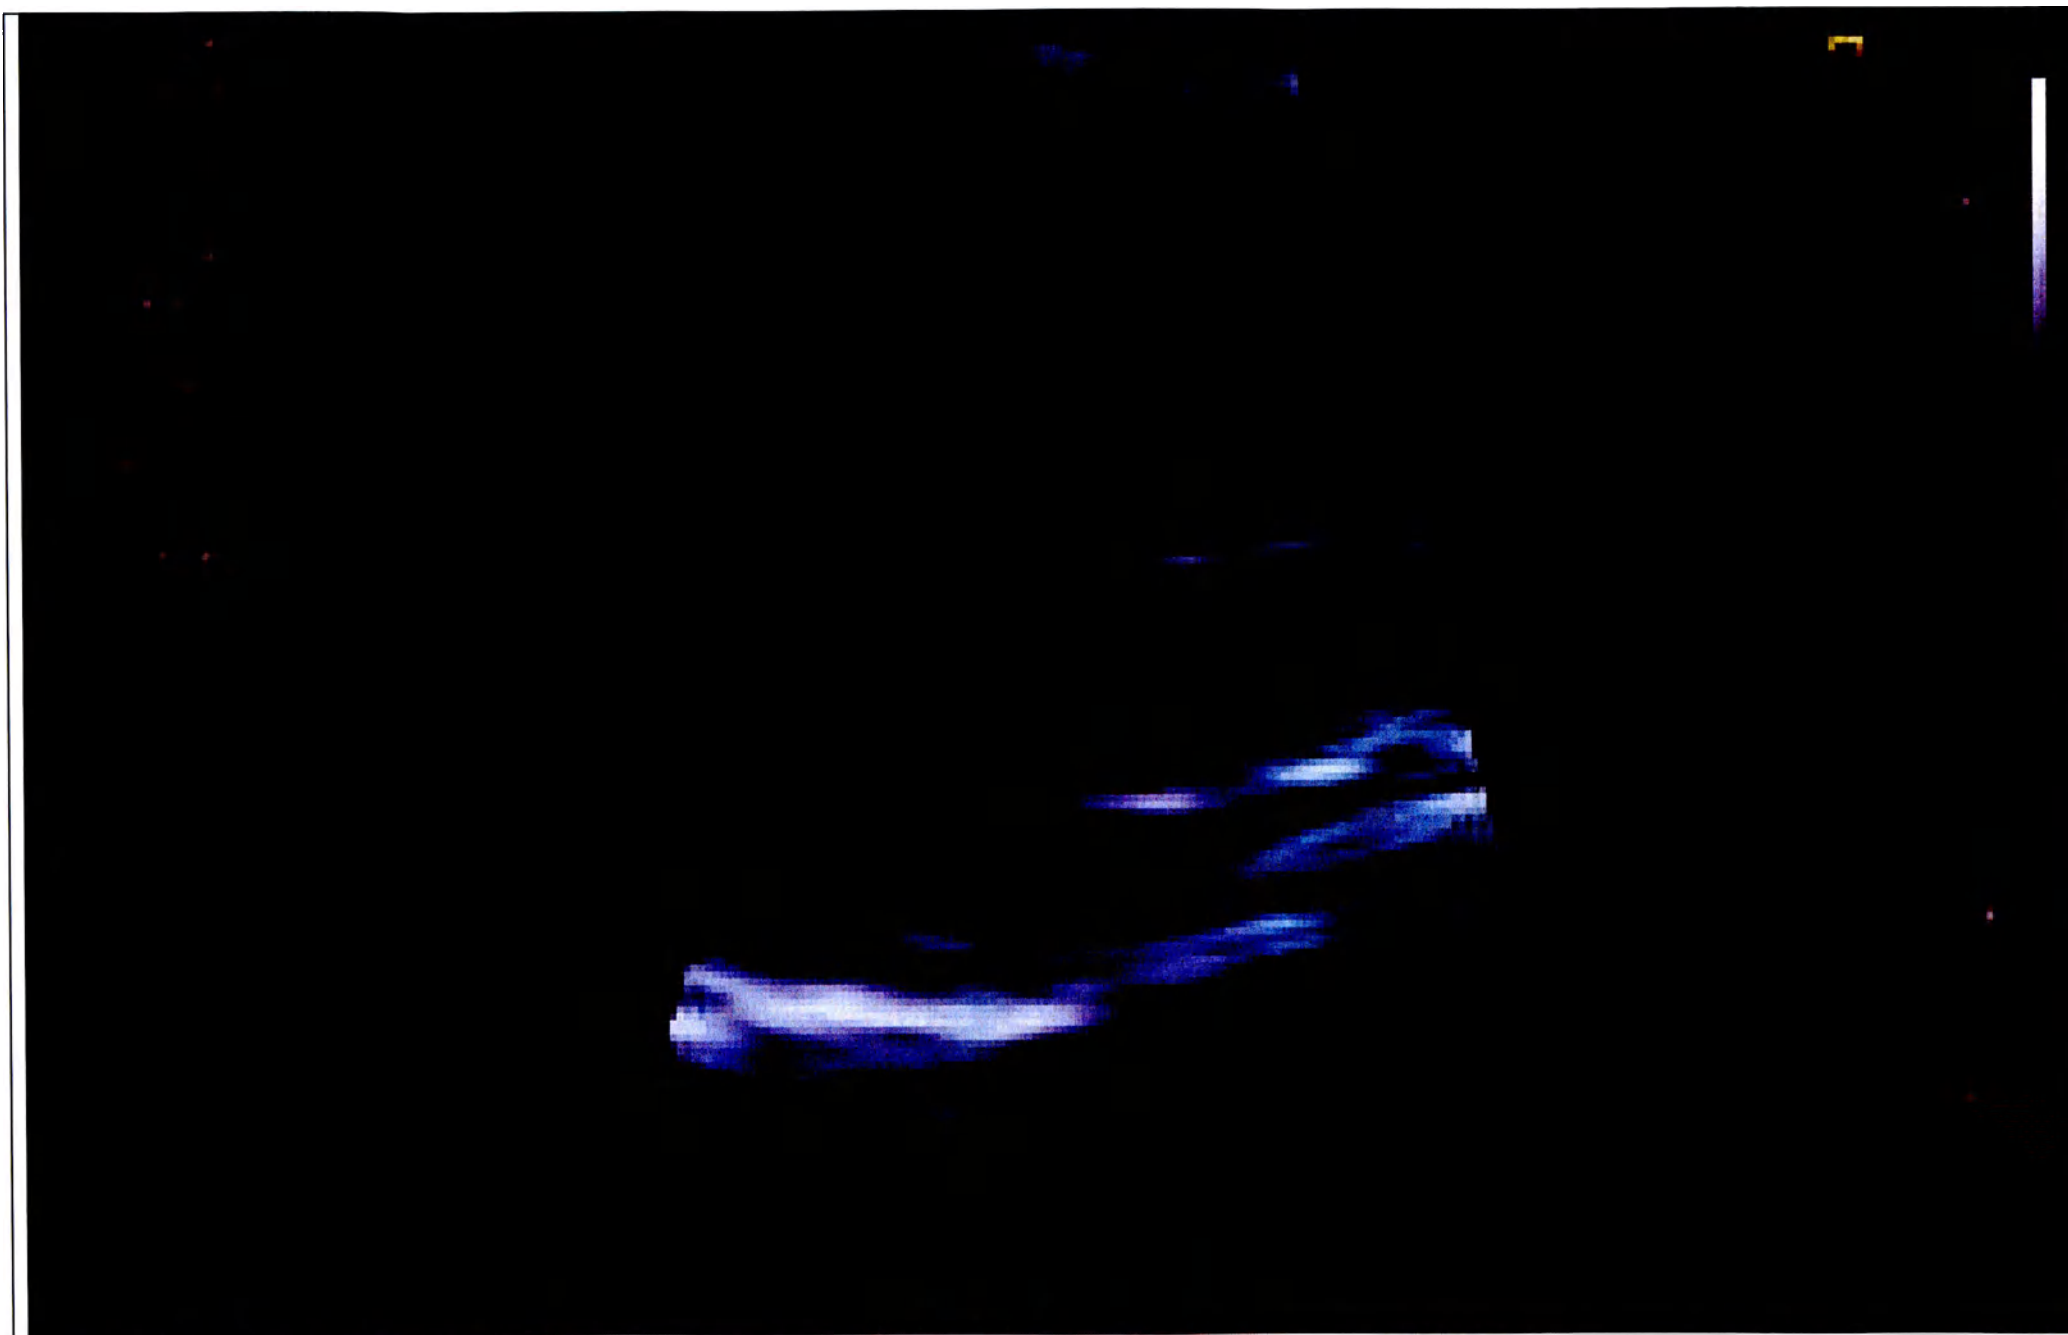


Рисунок 11. Лицензионный ключ для функции масштабирования с высоким разрешением (HD) на оптическом и/или электронном носителе.

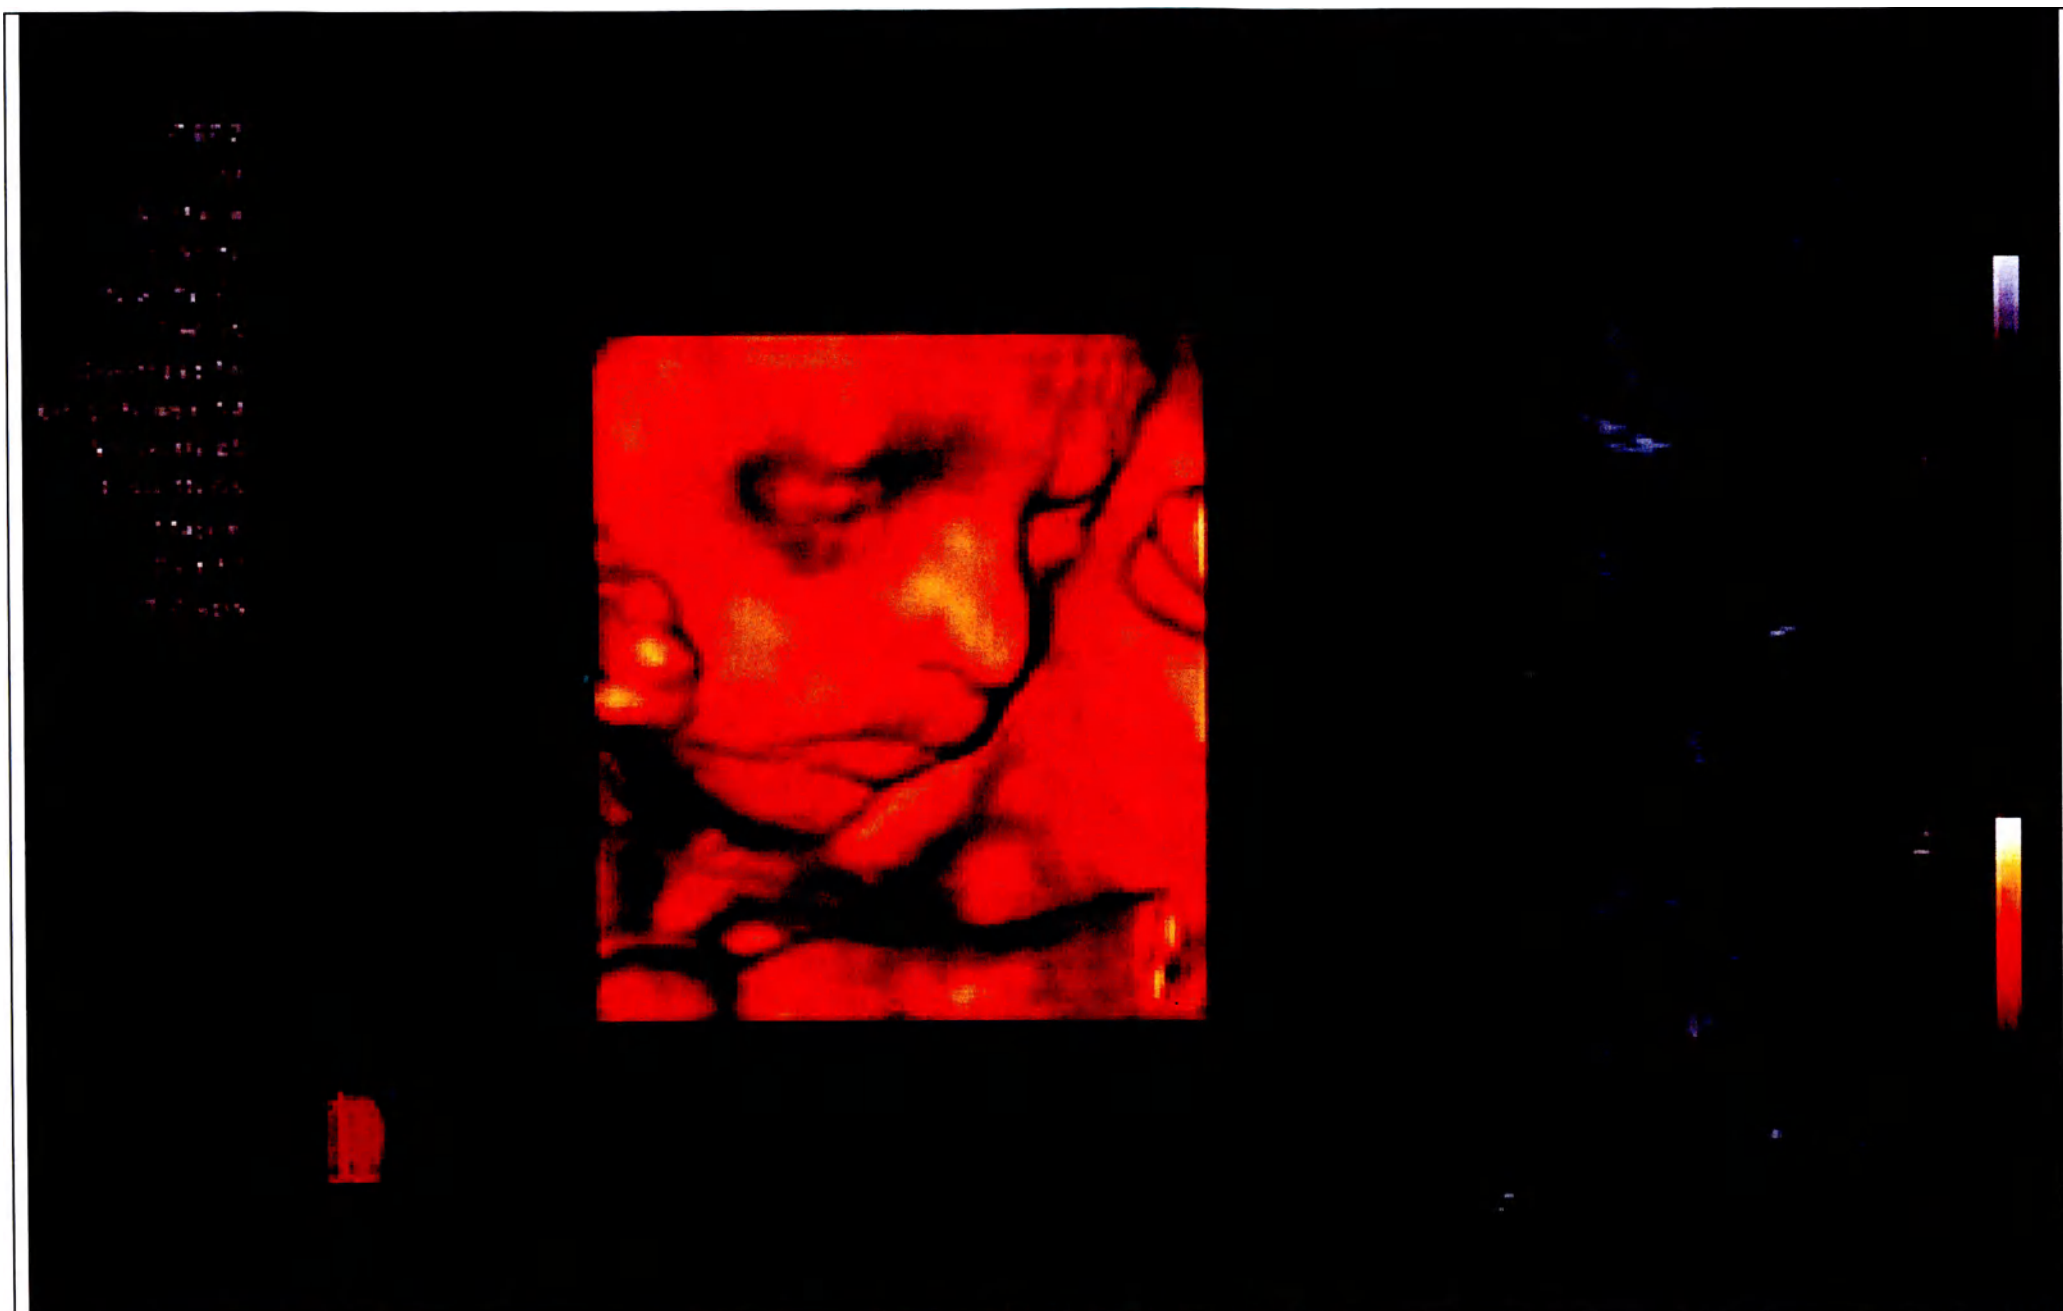


Рисунок 12. Лицензионный ключ для функции четырехмерной визуализации (fourSight 4D) на оптическом и/или электронном носителе.

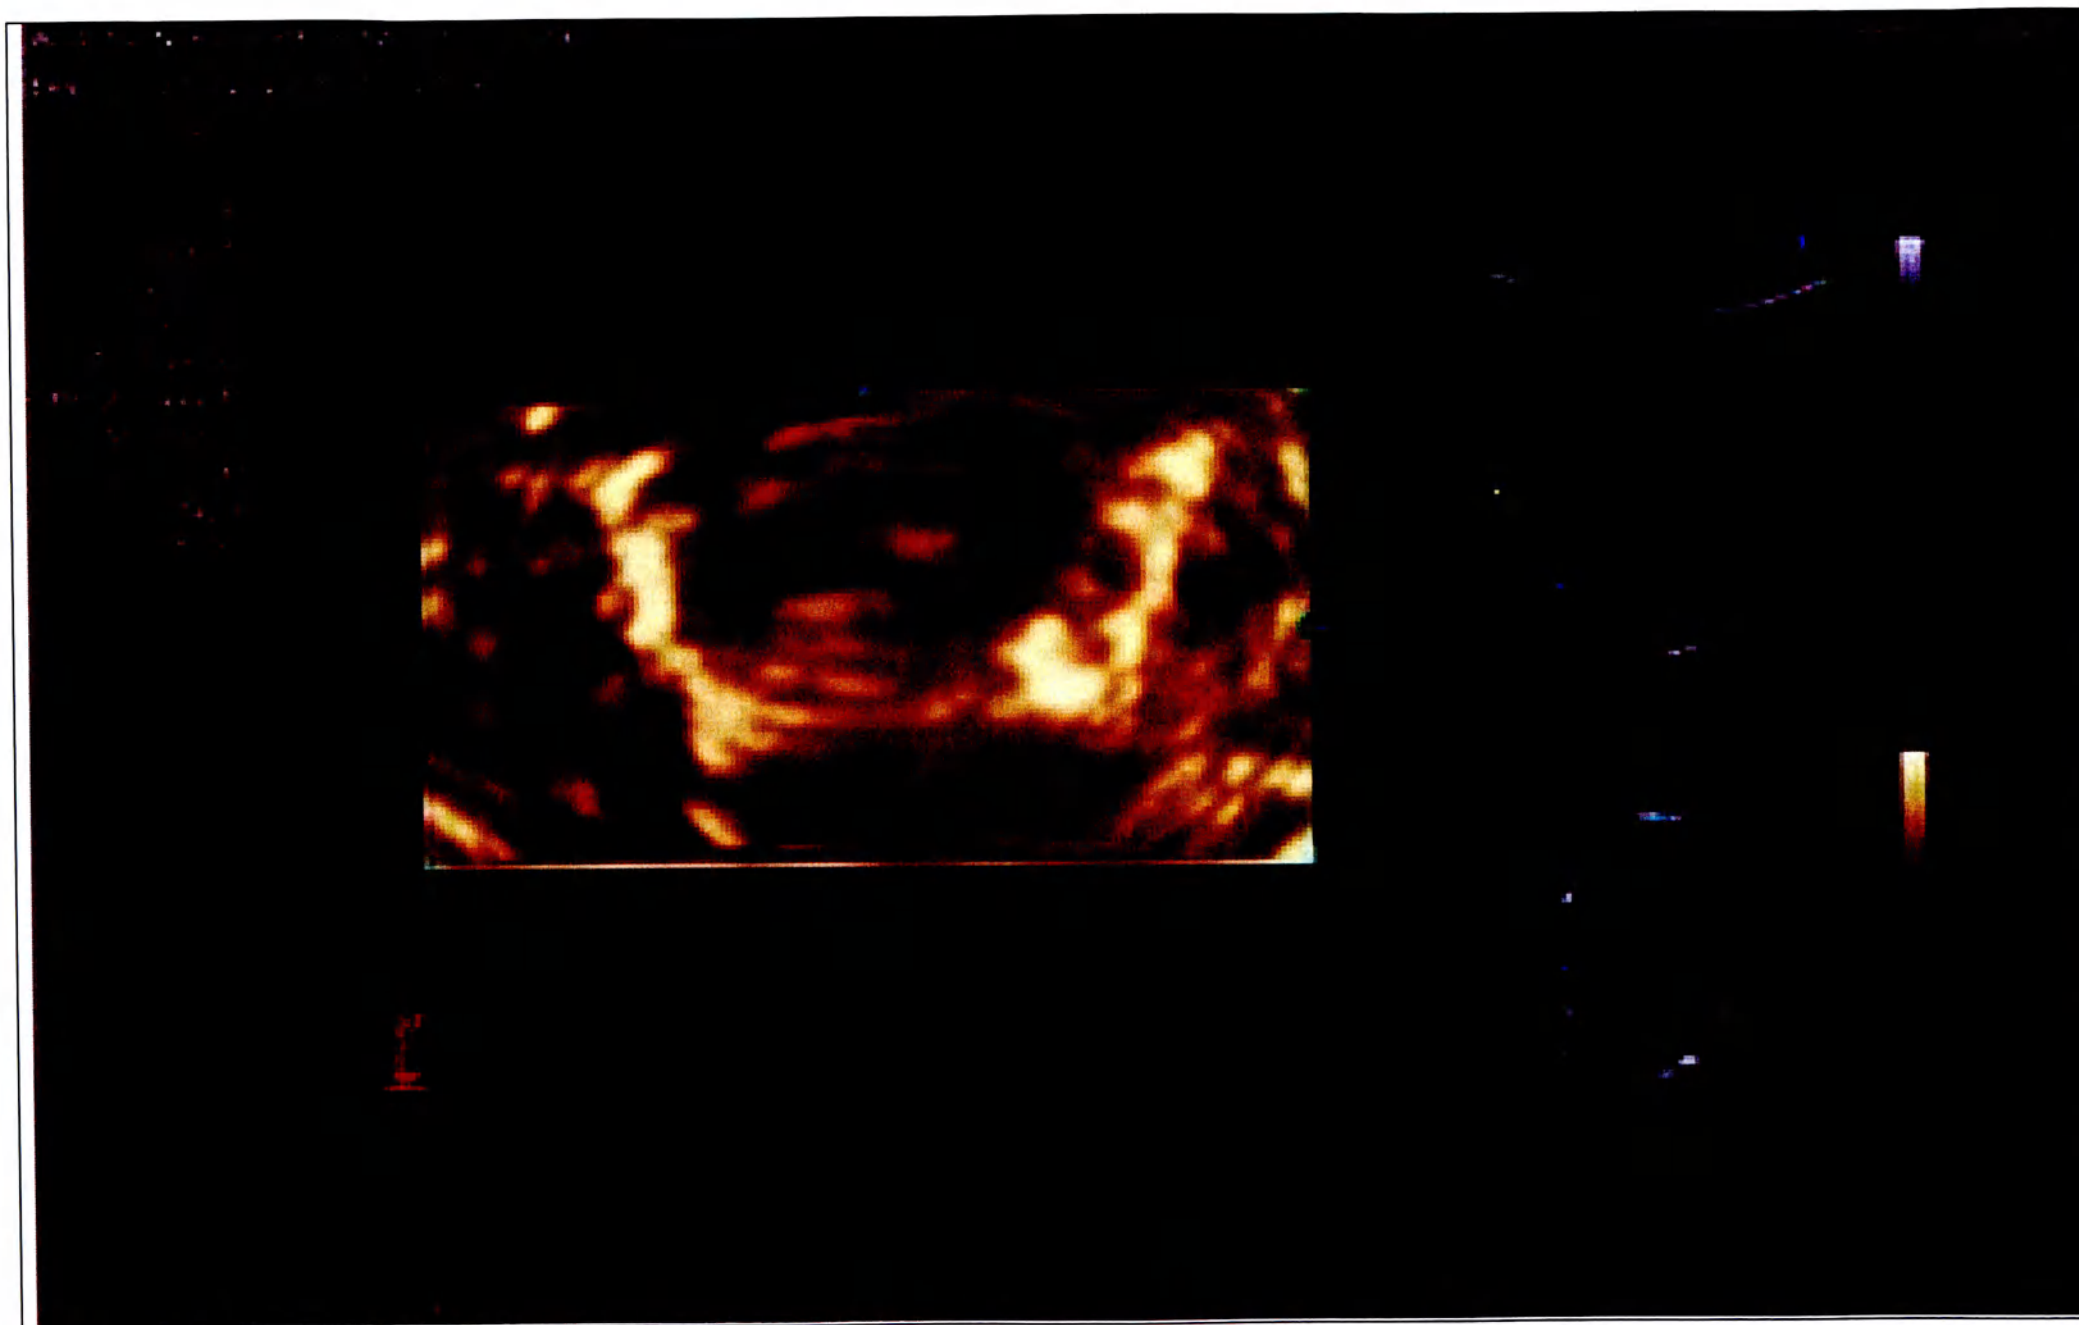


Рисунок 13. Лицензионный ключ для функции трехмерной визуализации (3-Scape) на оптическом и/или электронном носителе.

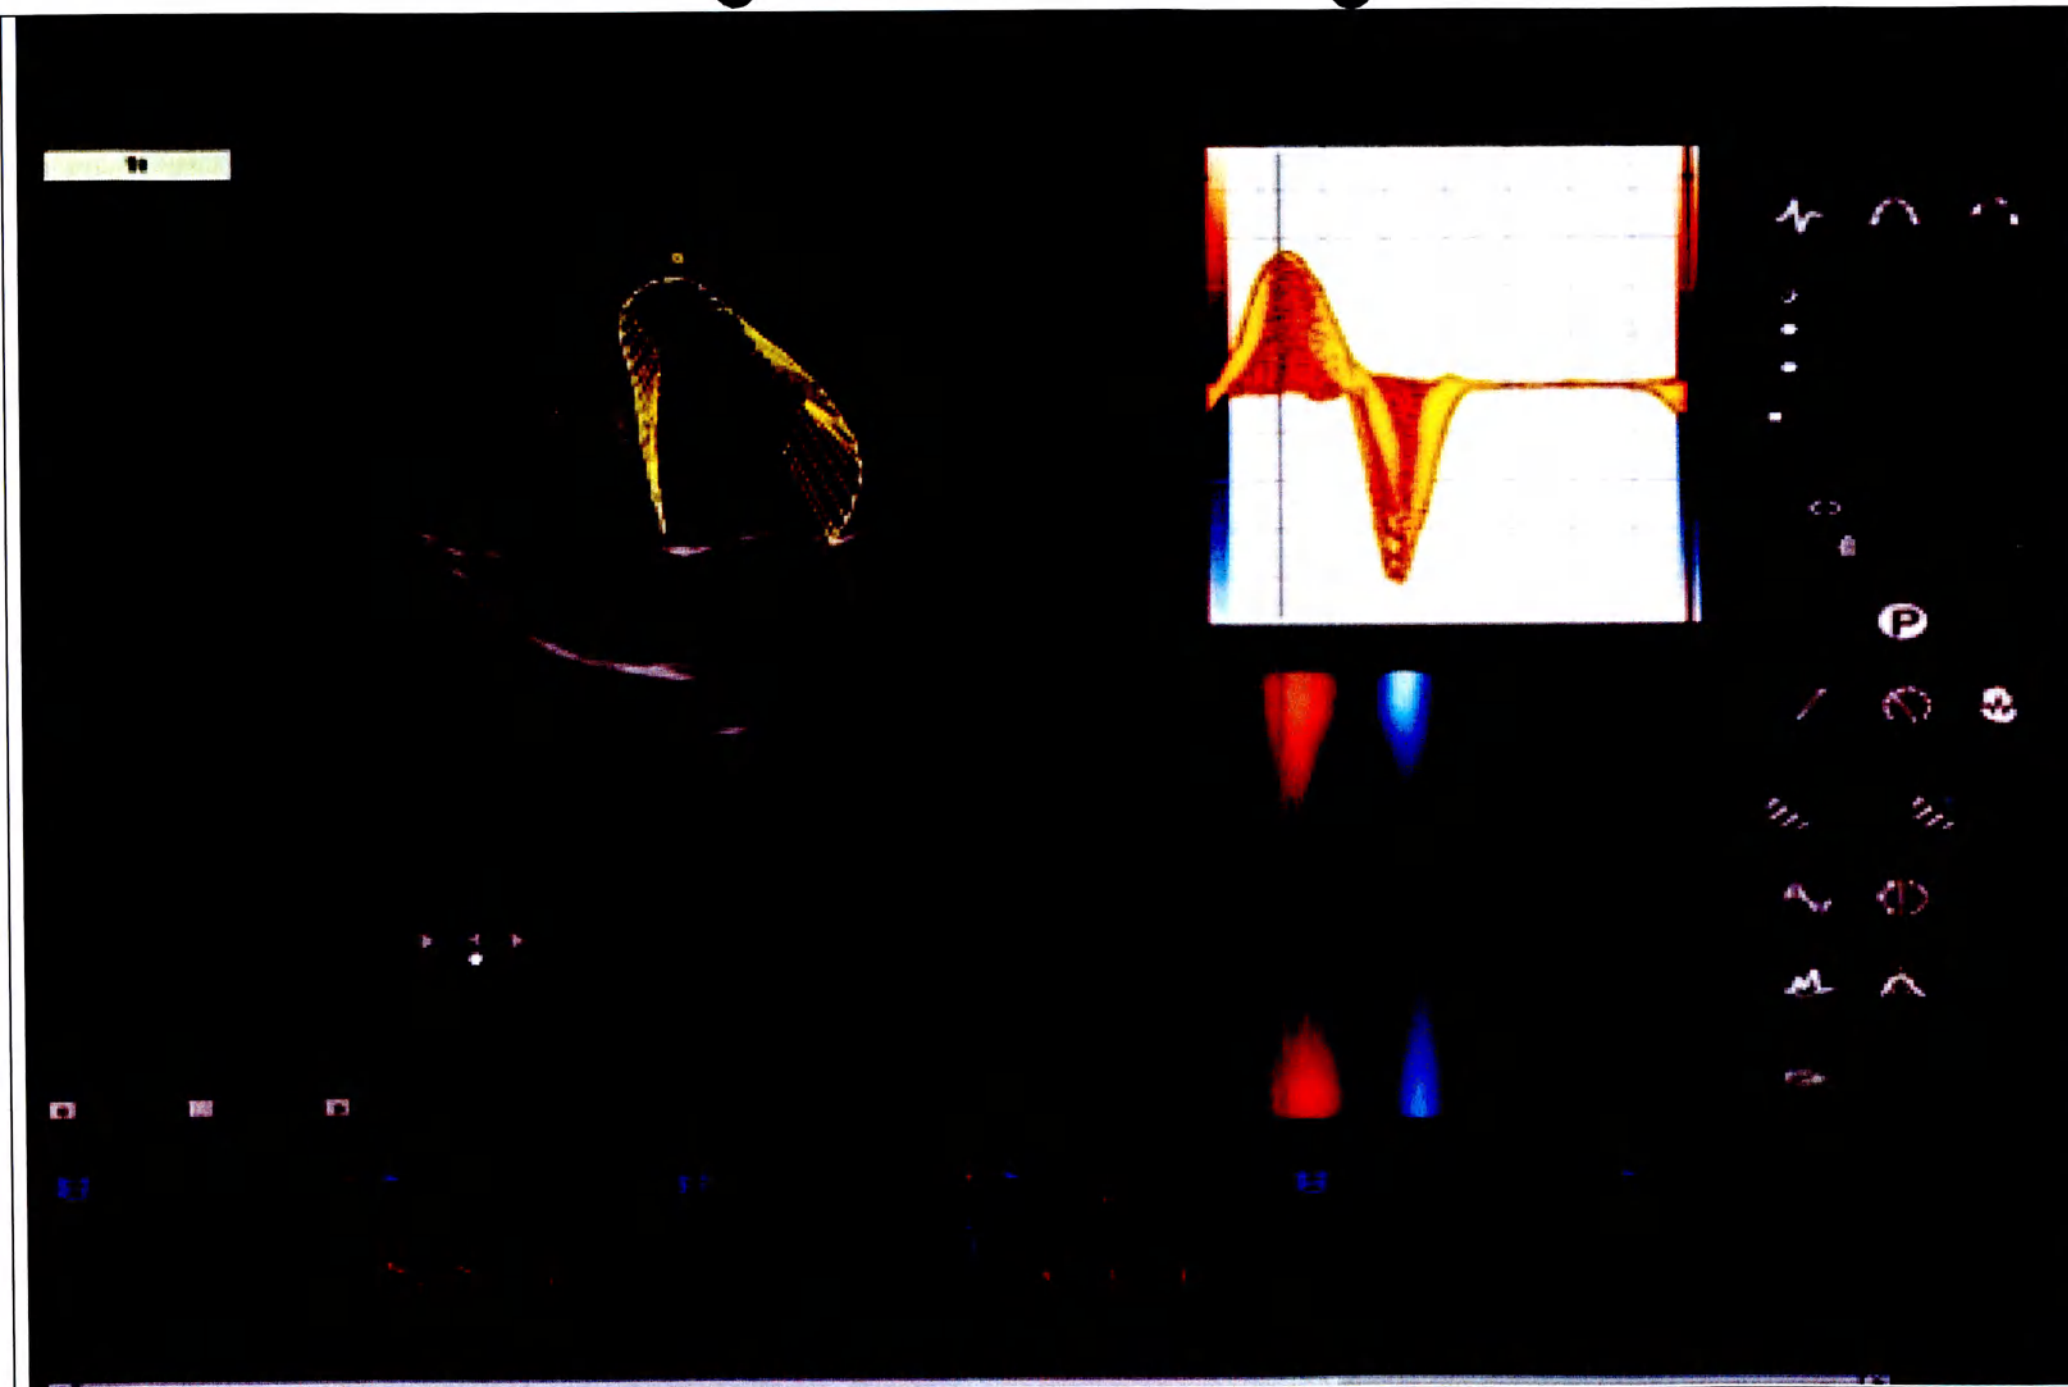


Рисунок 14. Лицензионный ключ для физиологического модуля с функцией ЭКГ на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 15. Лицензионный ключ для функции стресс-эхокардиографии на оптическом и/или электронном носителе.

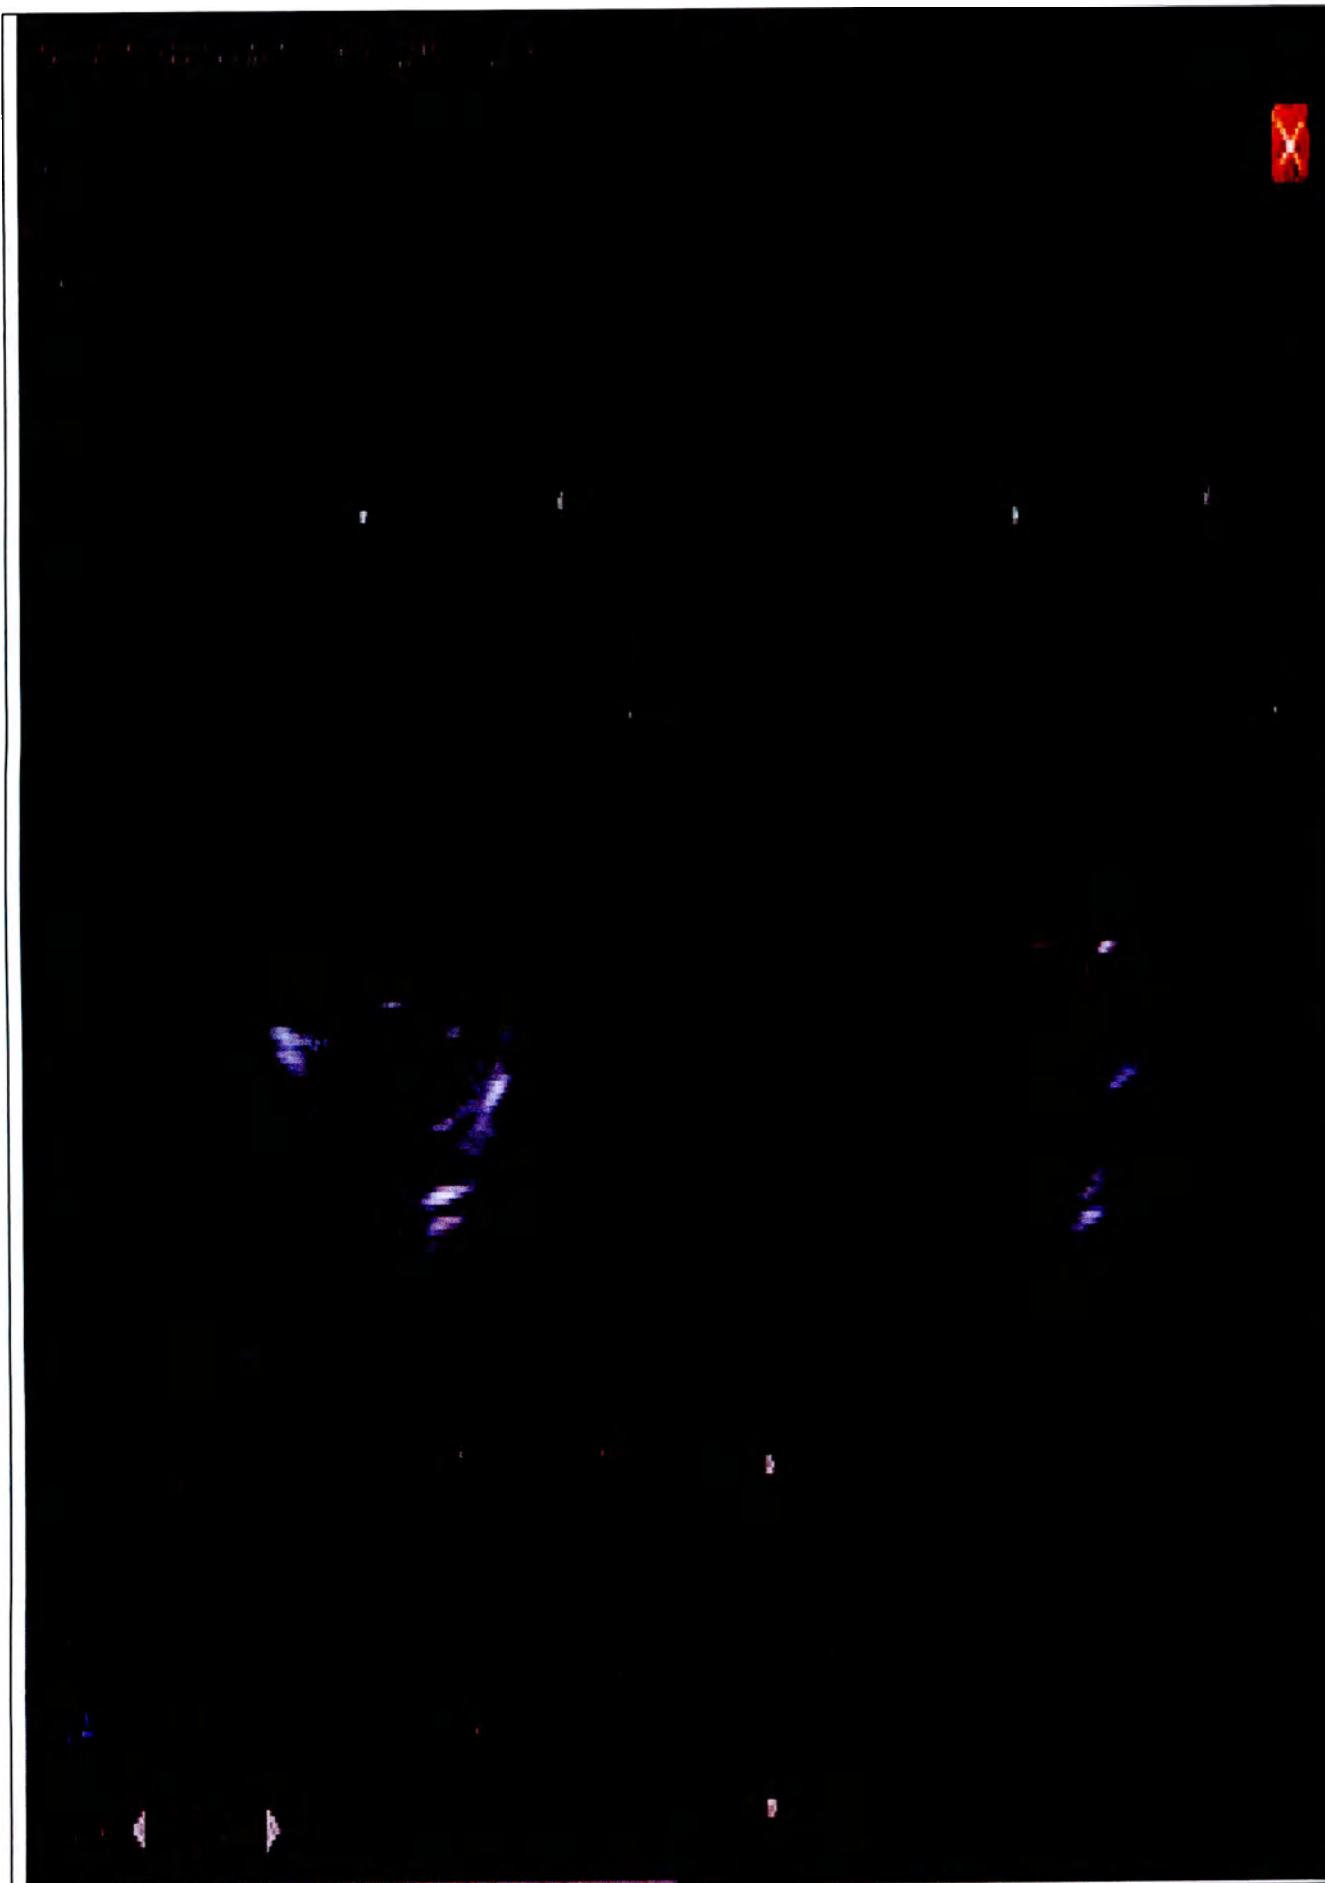


Рисунок 16. Лицензионный ключ для опции автоматического исследования левых отделов сердца (syngo Auto Left Heart) на оптическом и/или электронном носителе.

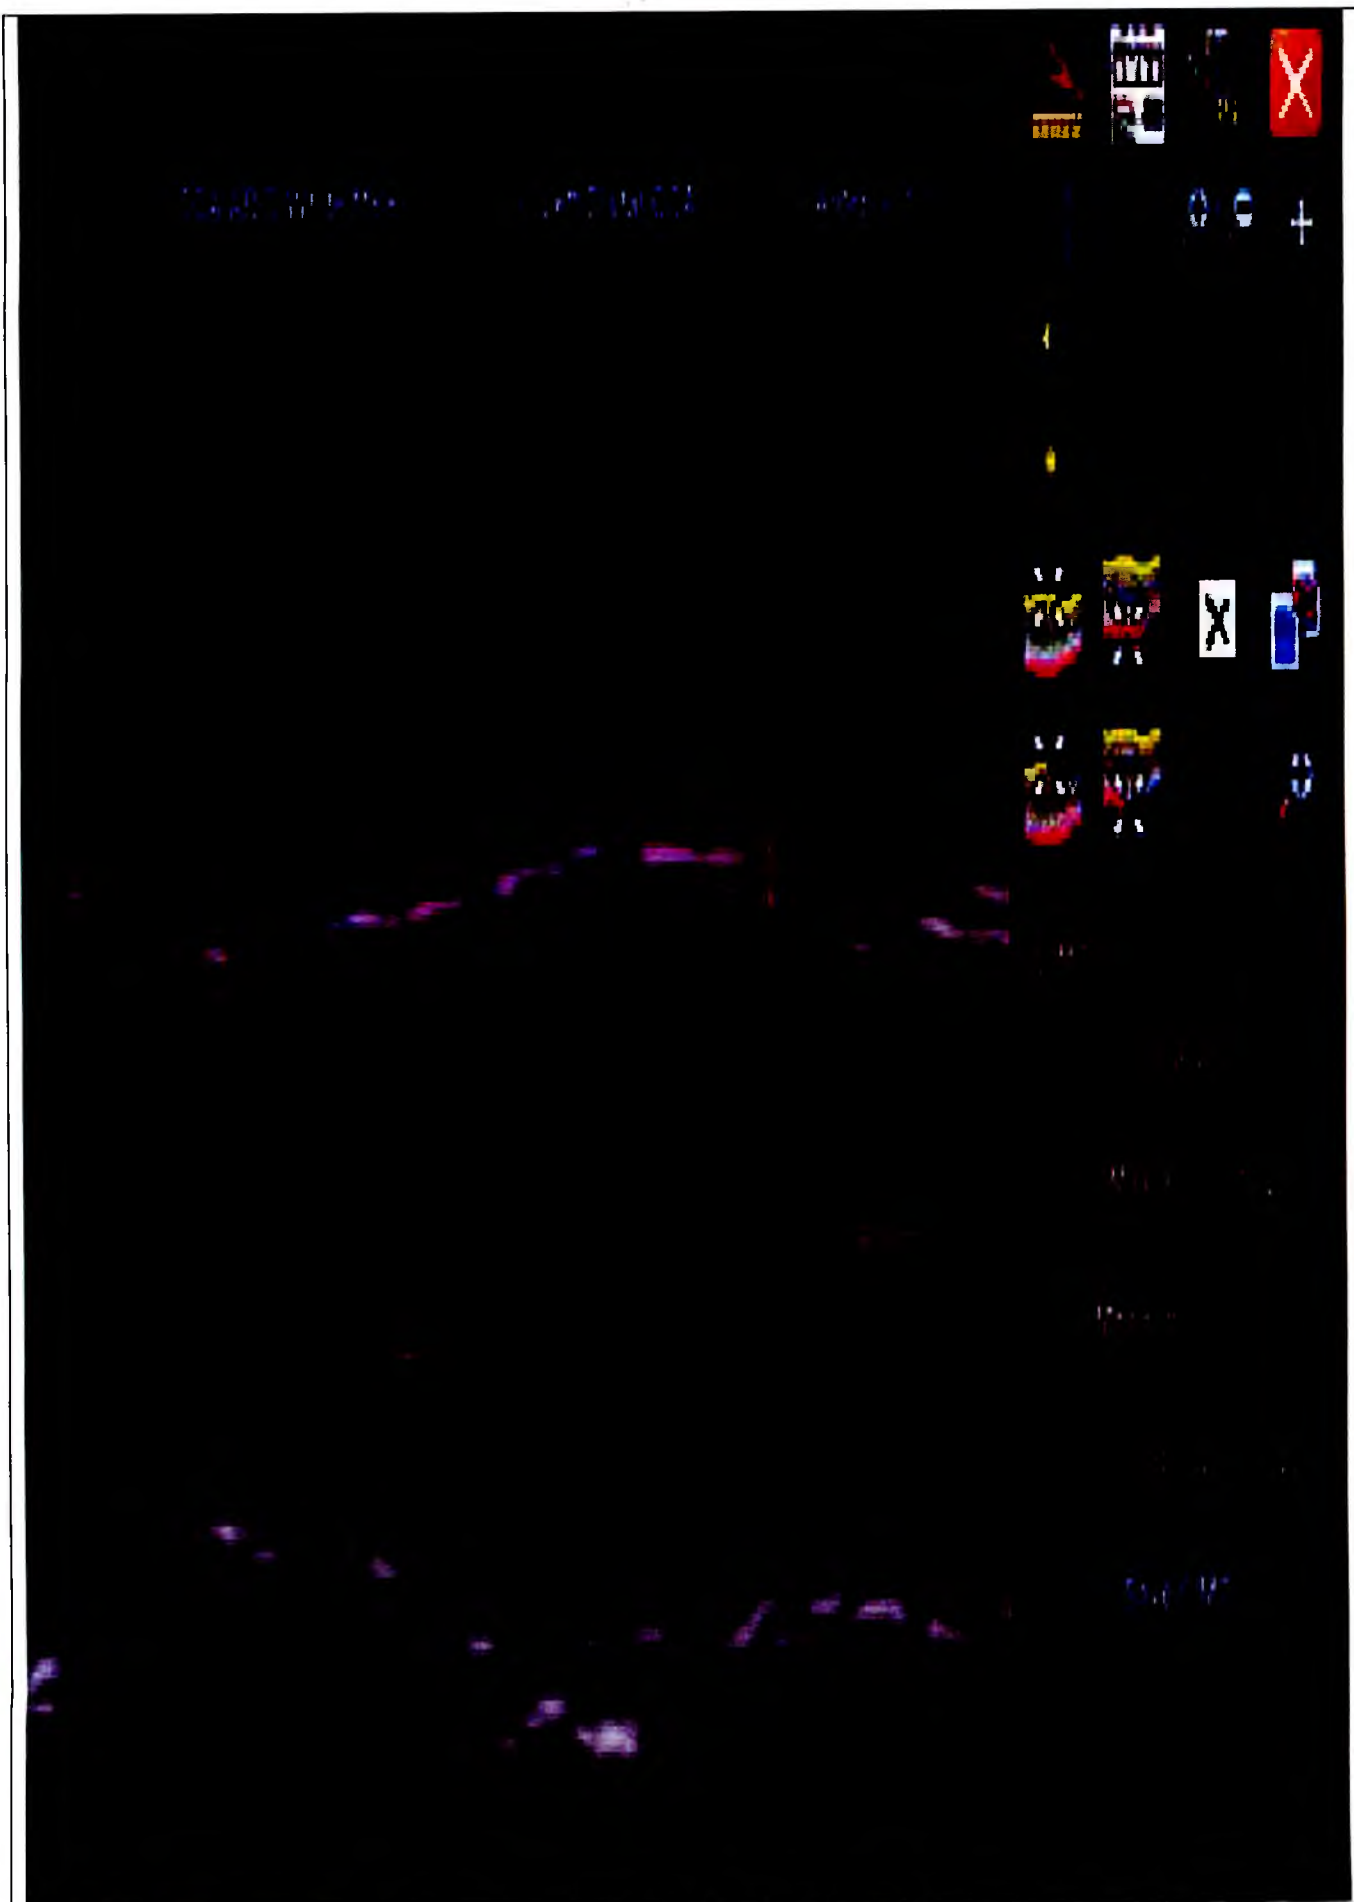


Рисунок 17. Лицензионный ключ для программного обеспечения полуавтоматического обнаружения границ и количественного анализа толщины интима - медиа сонных артерий syngo Arterial Health Package (AHP) на оптическом и/или электронном носителе.

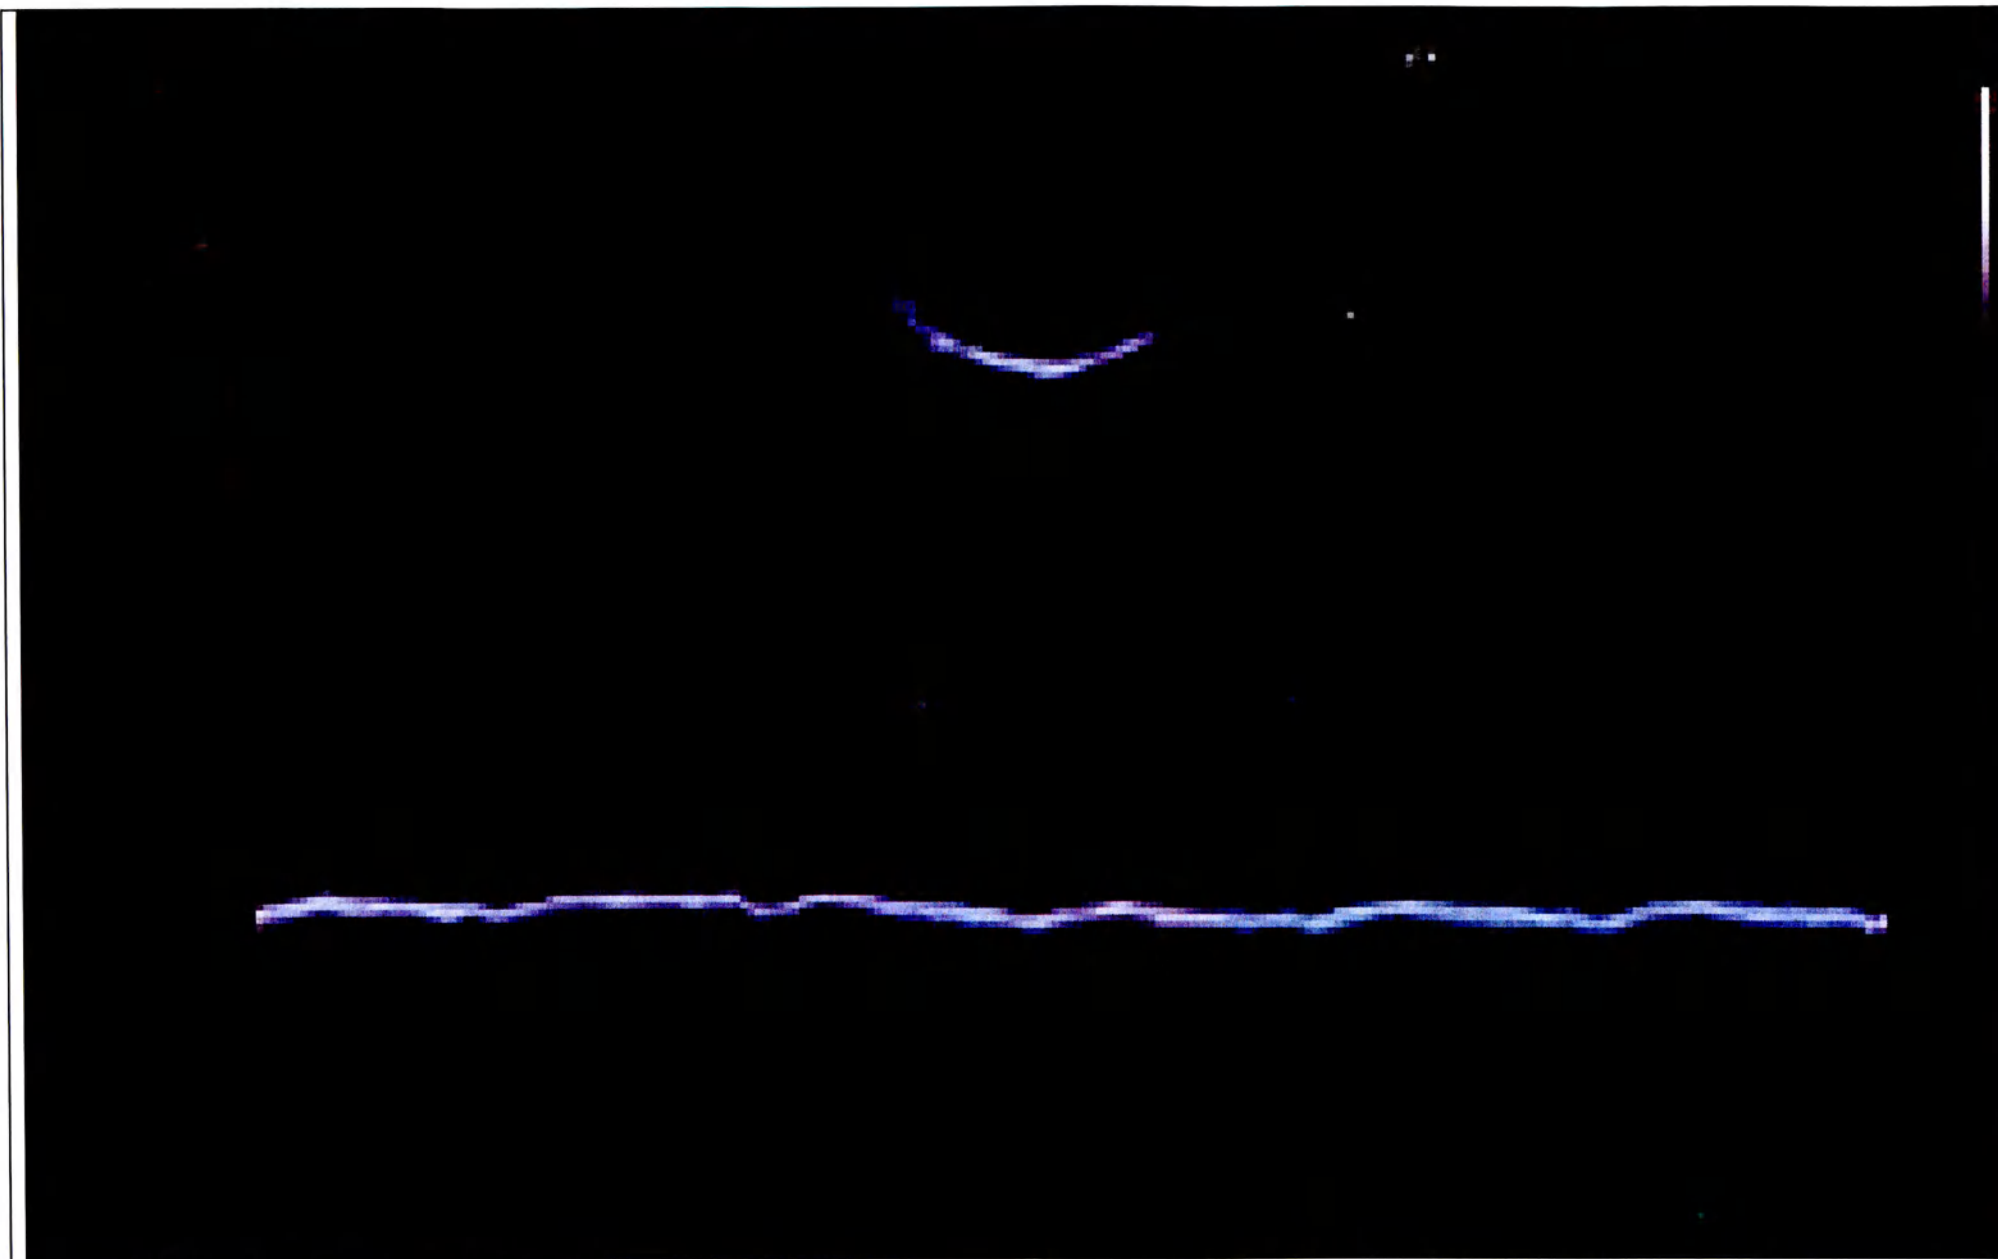


Рисунок 18. Лицензионный ключ для функции анатомического М-режима (АММ) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 19. Лицензионный ключ для удаленного сервисного обслуживания (eSieLink) на оптическом и/или электронном носителе.

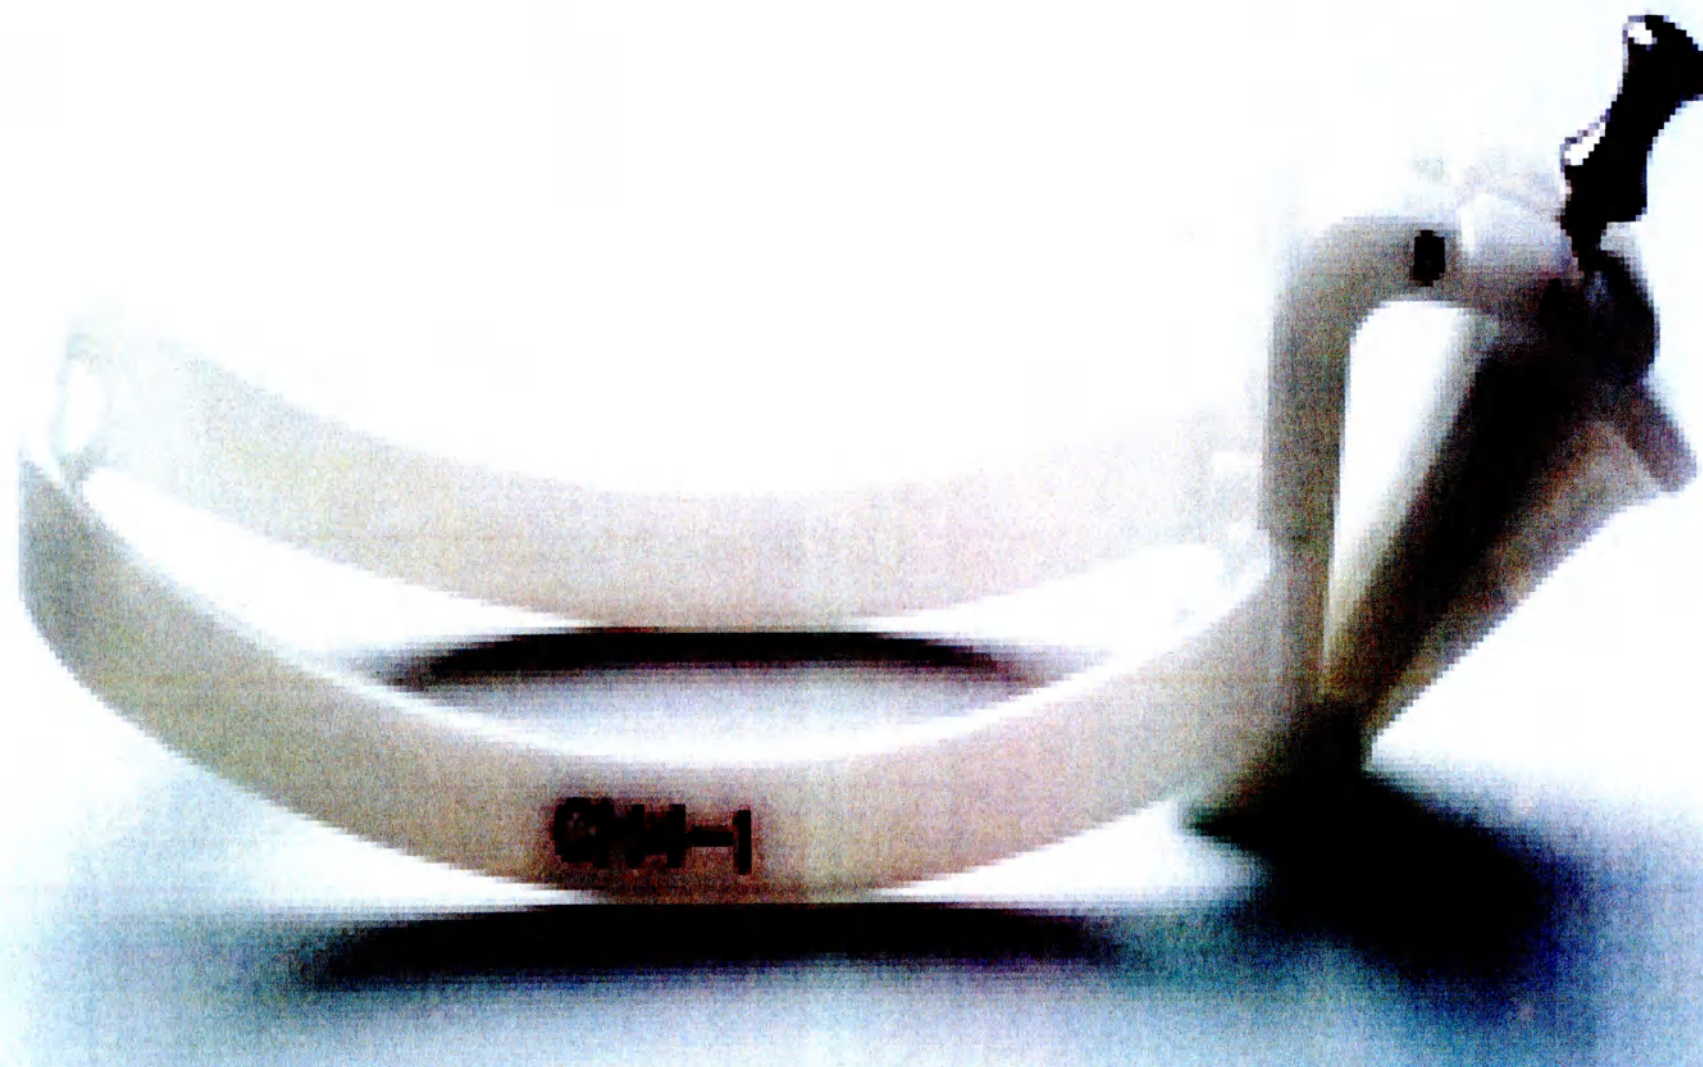
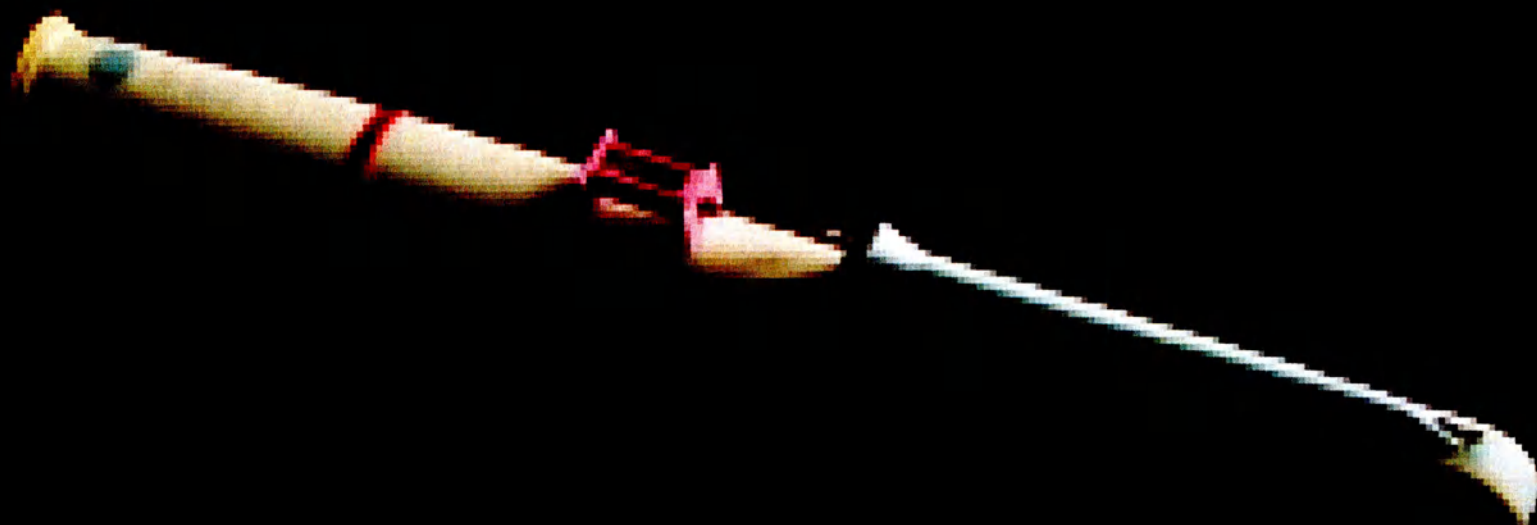



Рисунок 20. Адаптер иглопроводника к датчику CH5-2 – 1шт. (но не более 50 шт. при необходимости).



Рисунок 21. Адаптер иглопроводника к датчику C5-2v – 1шт. (но не более 50 шт. при необходимости).





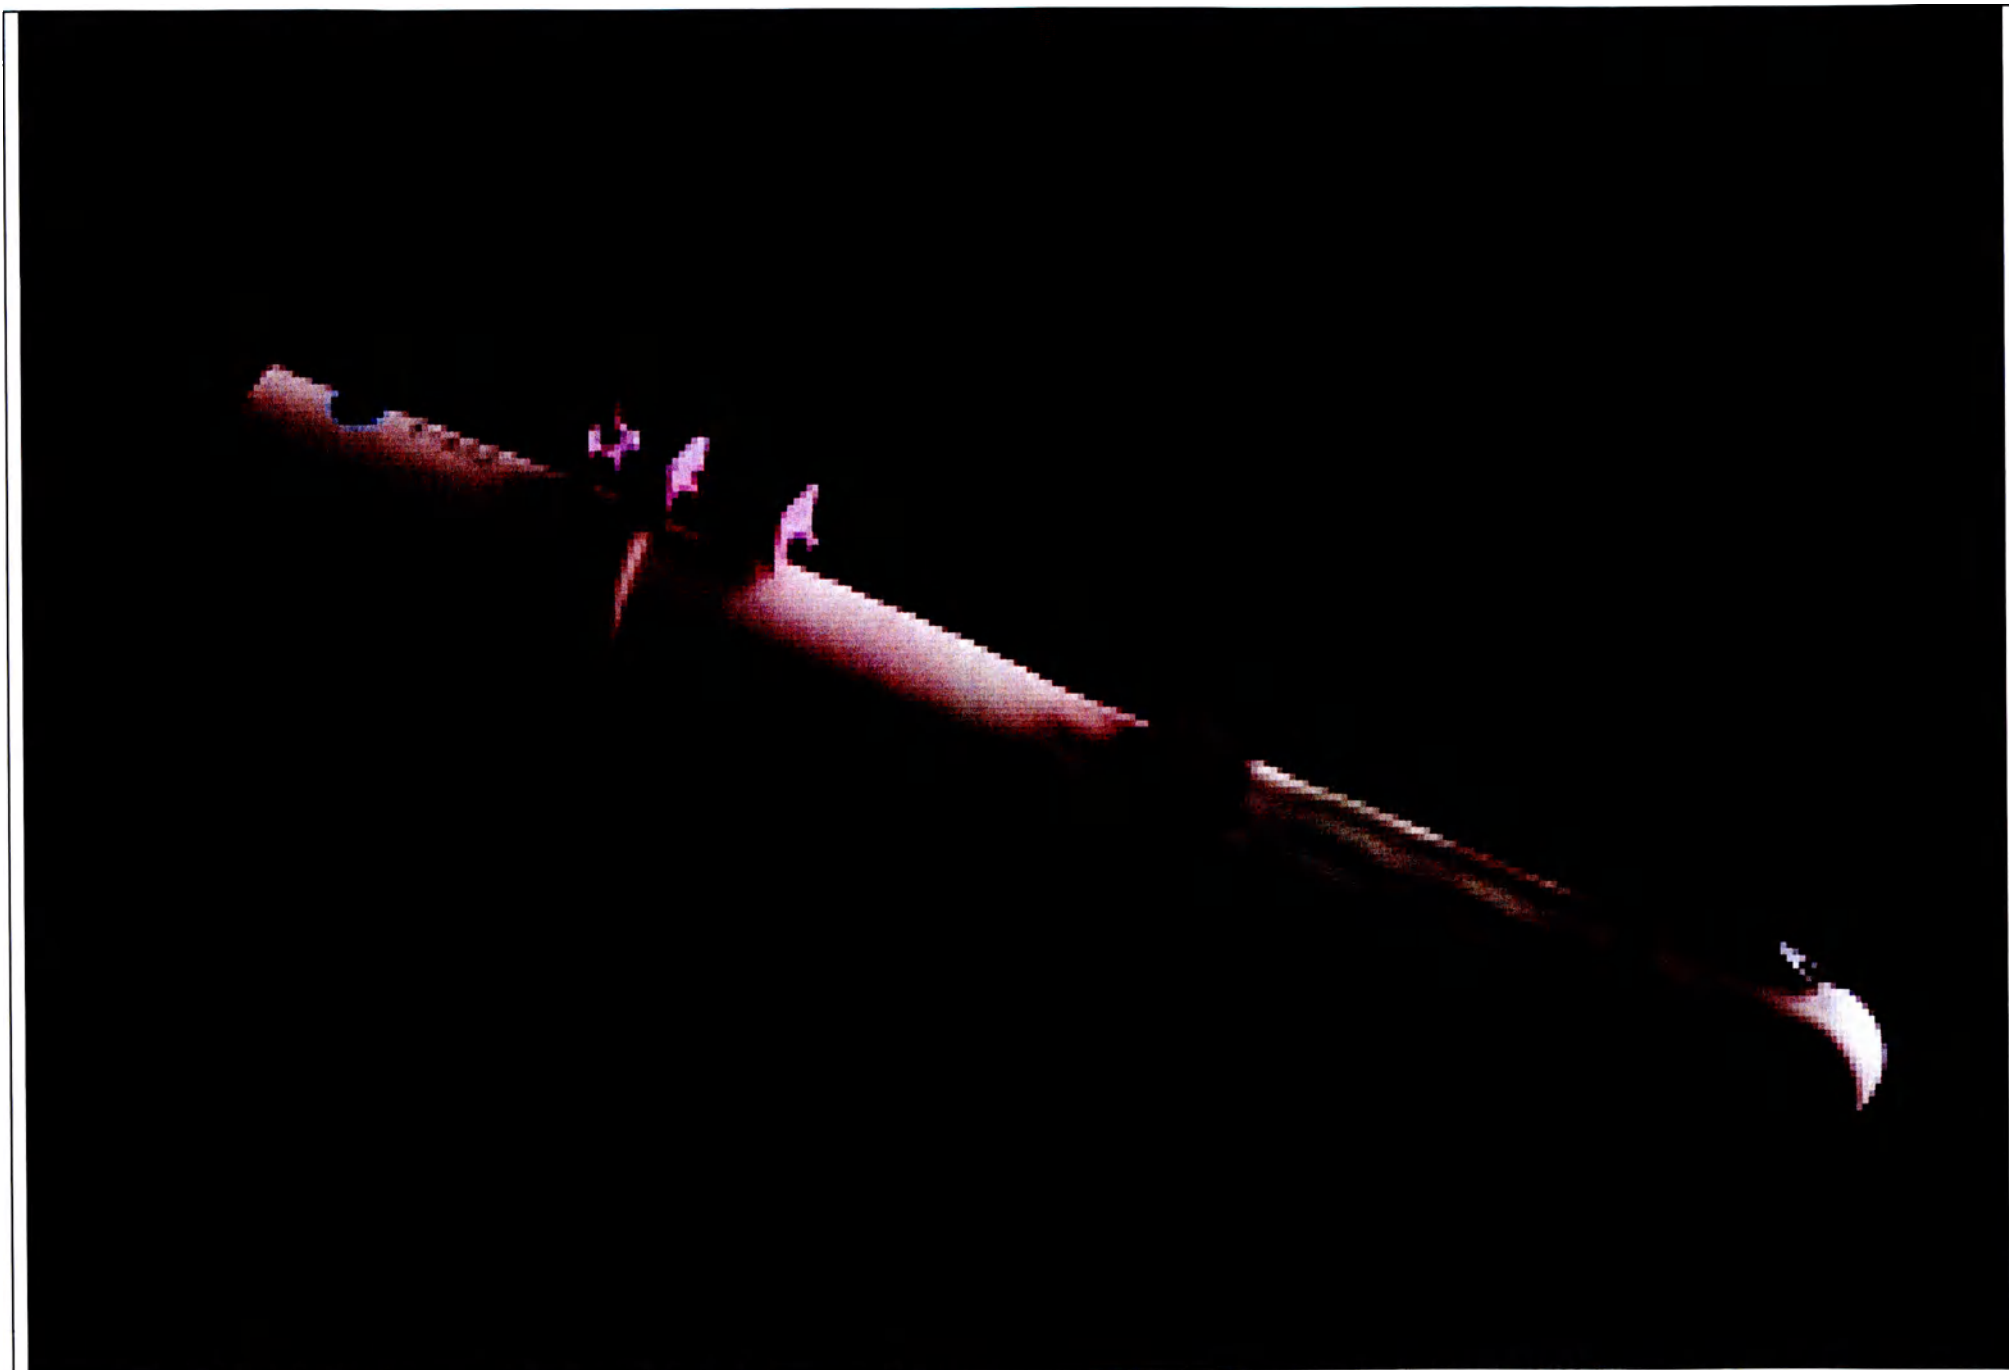

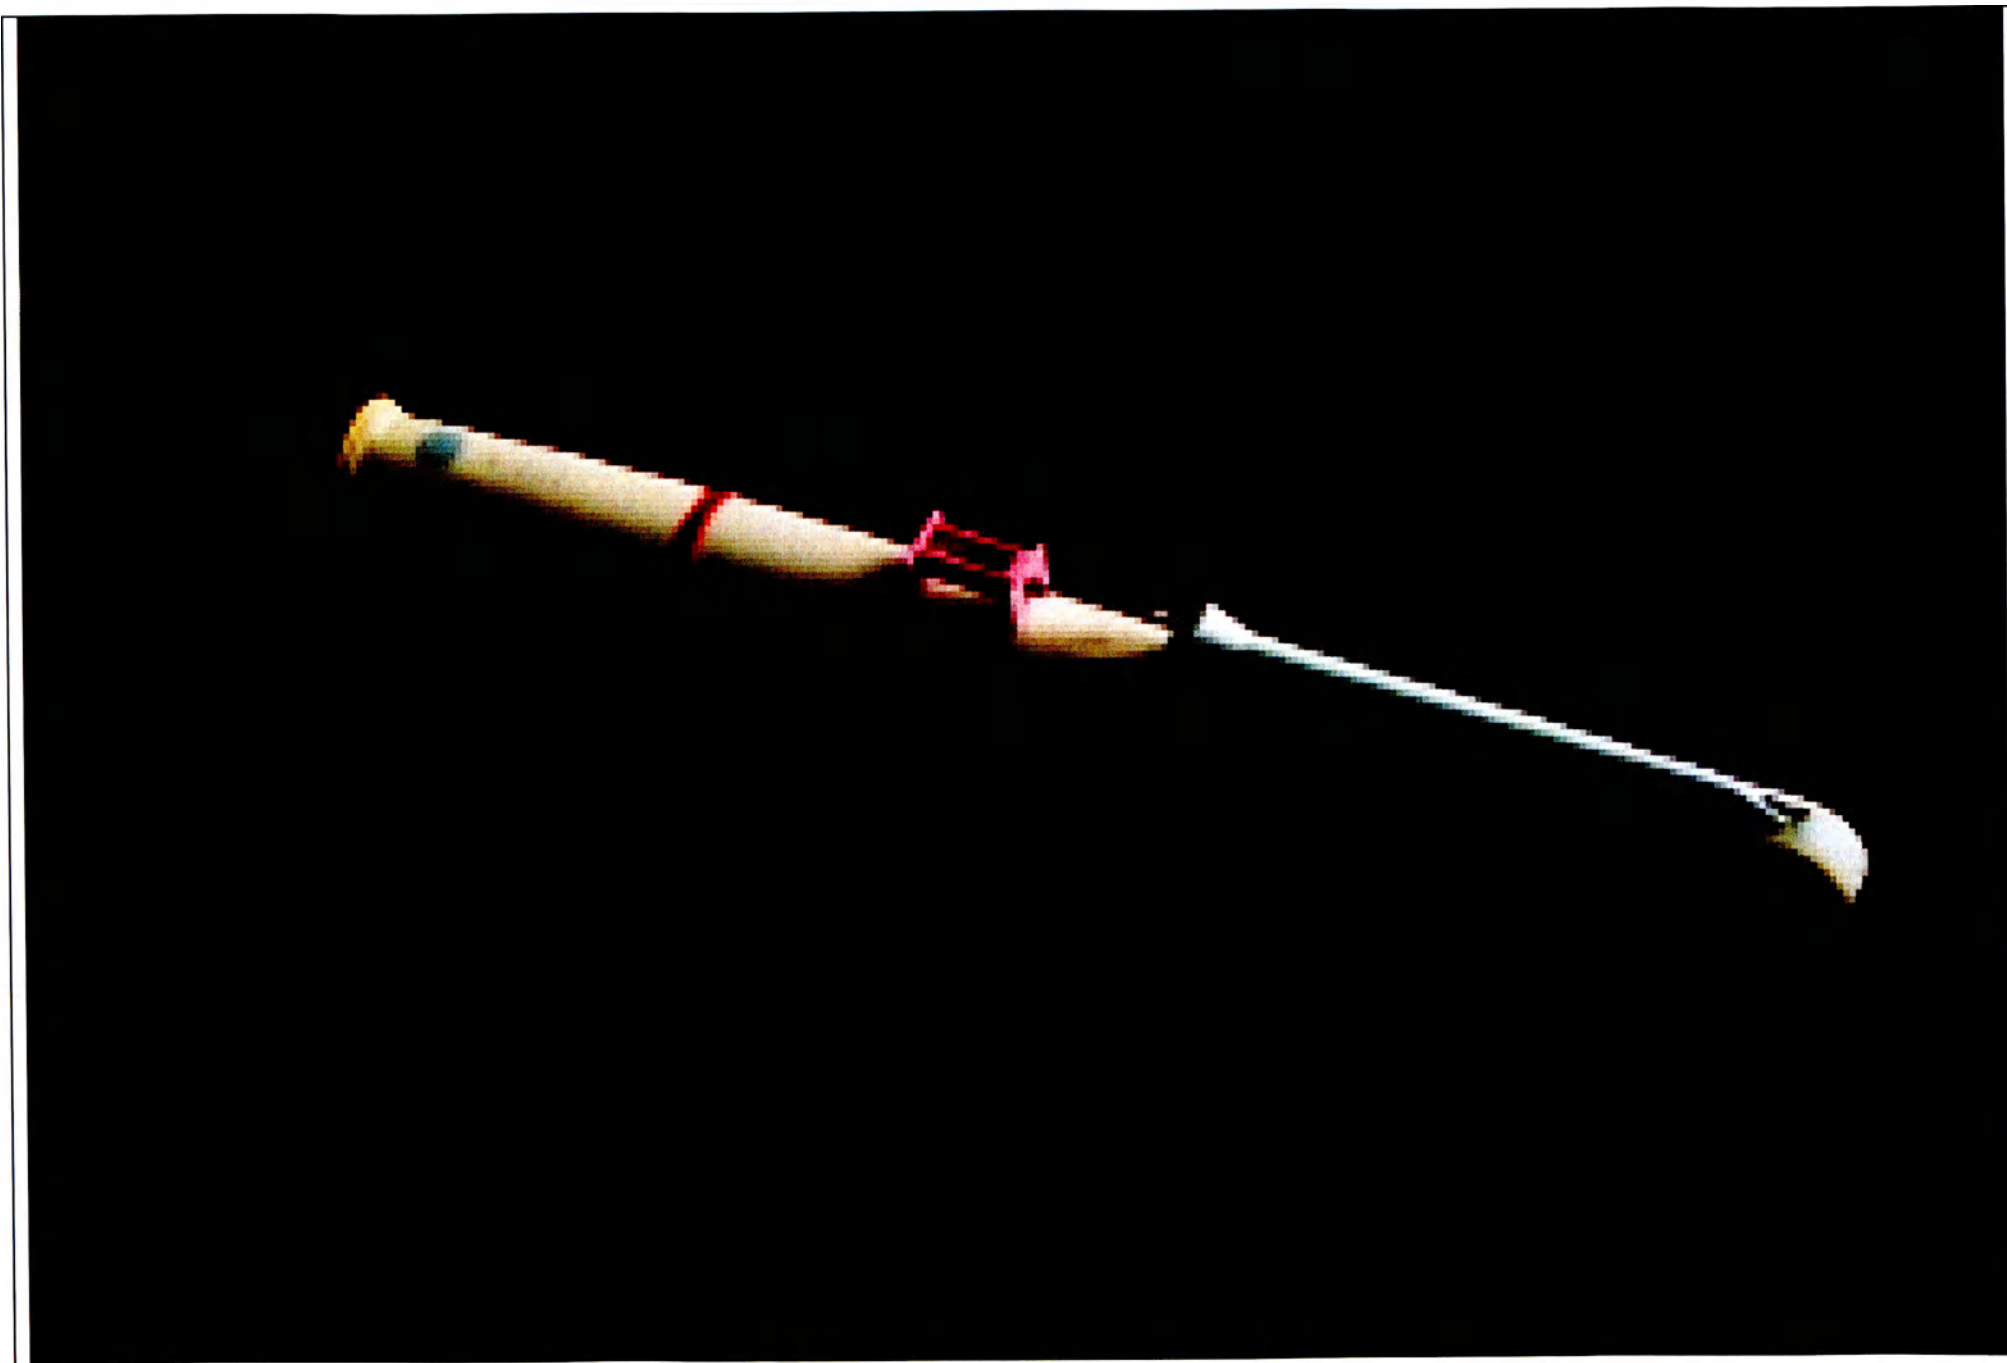




Рисунок 26. Адаптер иглопроводника к датчику VF10-5 – 1шт. (но не более 50 шт. при необходимости).



Рисунок 27. Адаптер иглопроводчика к датчику L10-5v – 1шт. (но не более 50 шт. при необходимости).



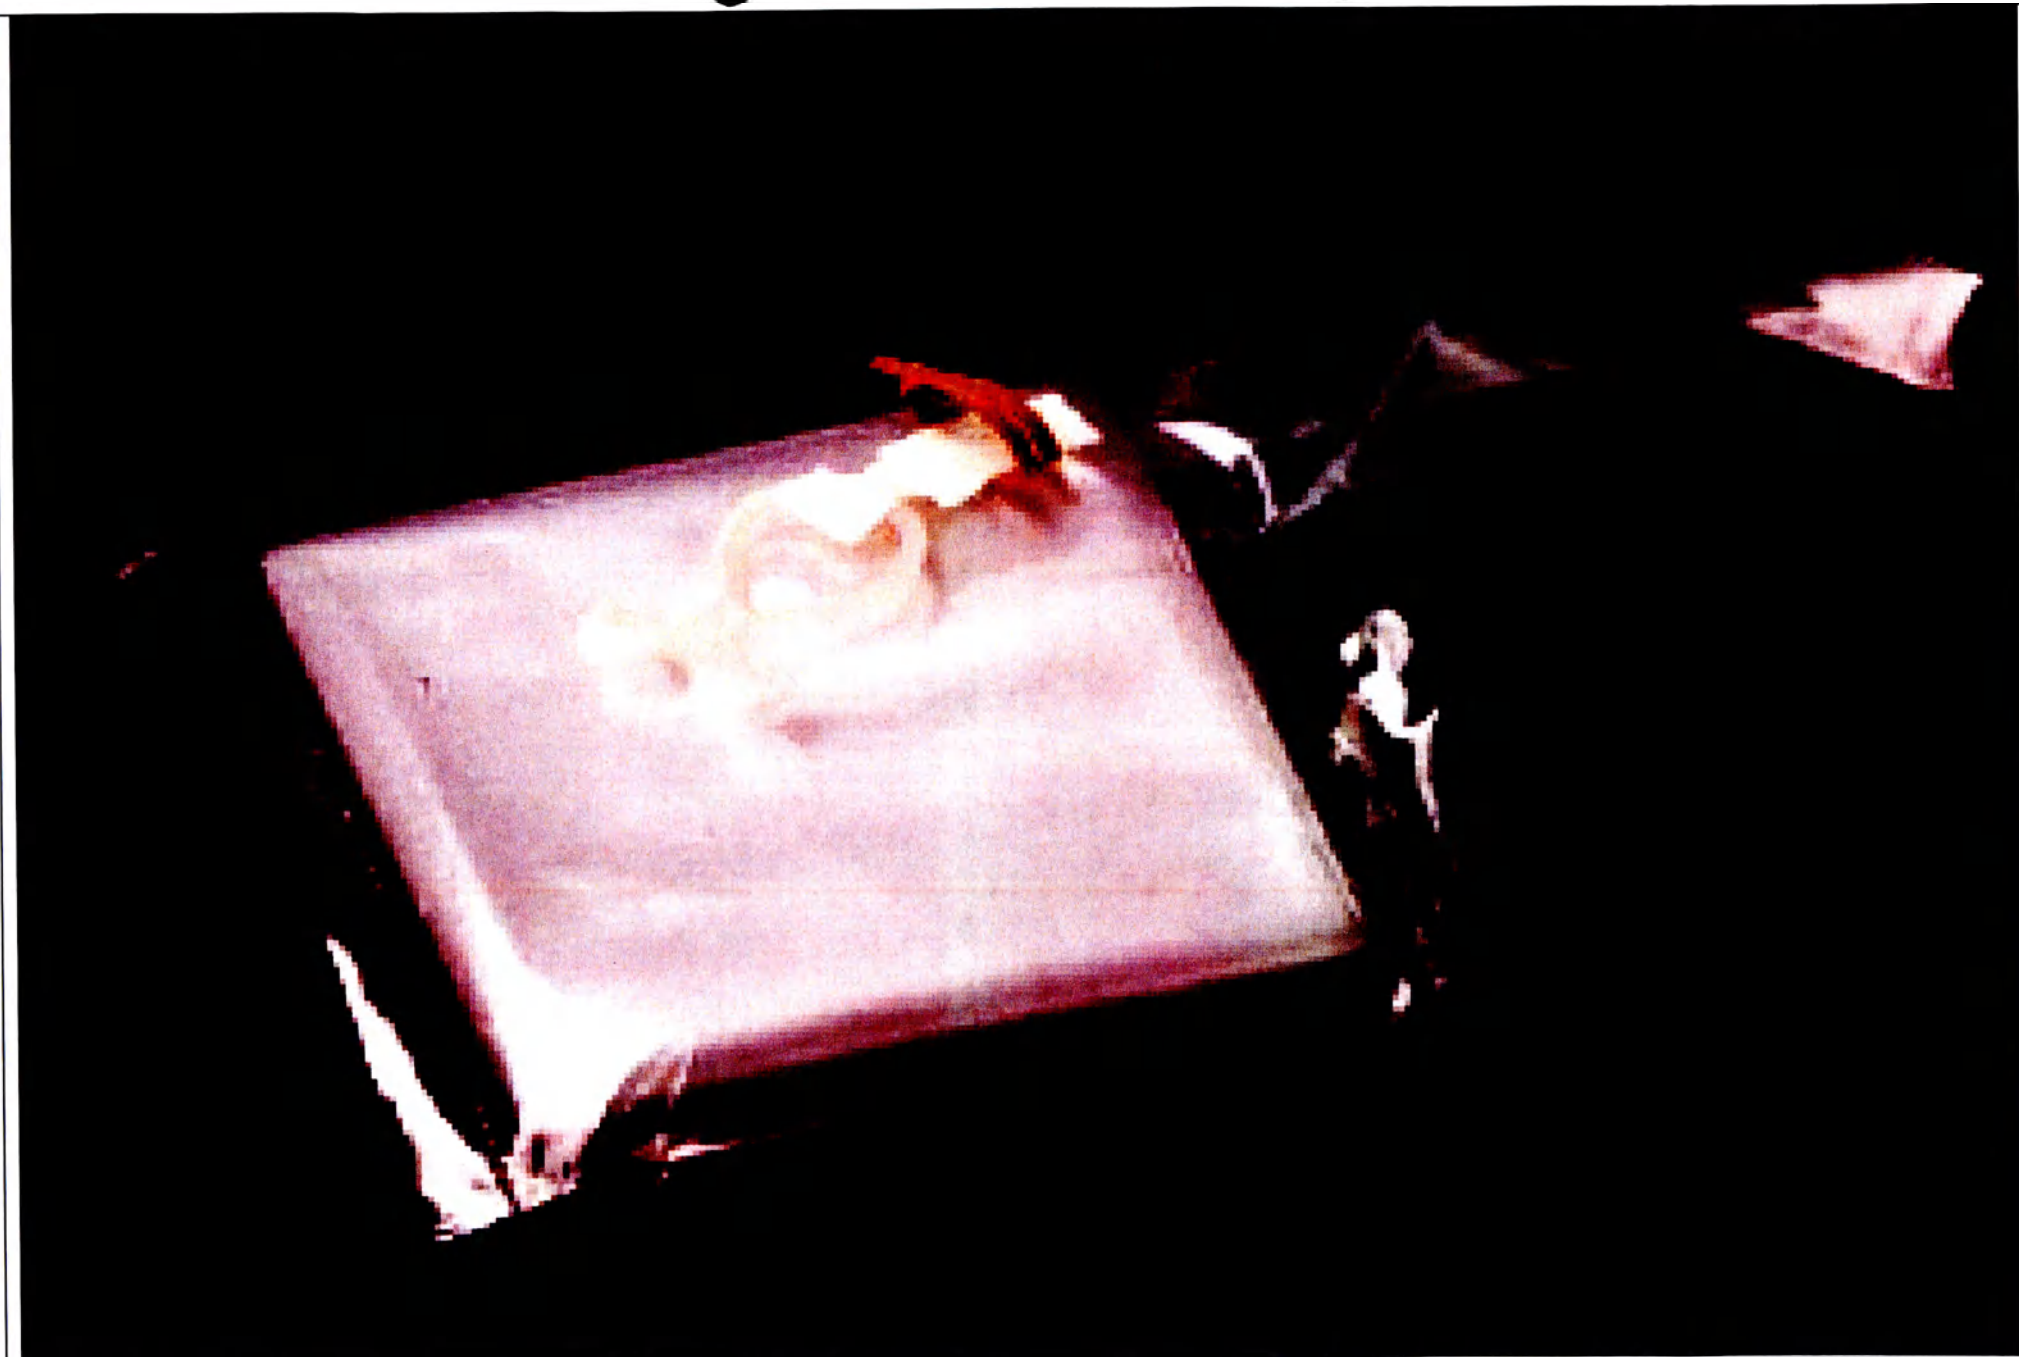


Рисунок 28b. Защитные стерильные оболочки для датчиков

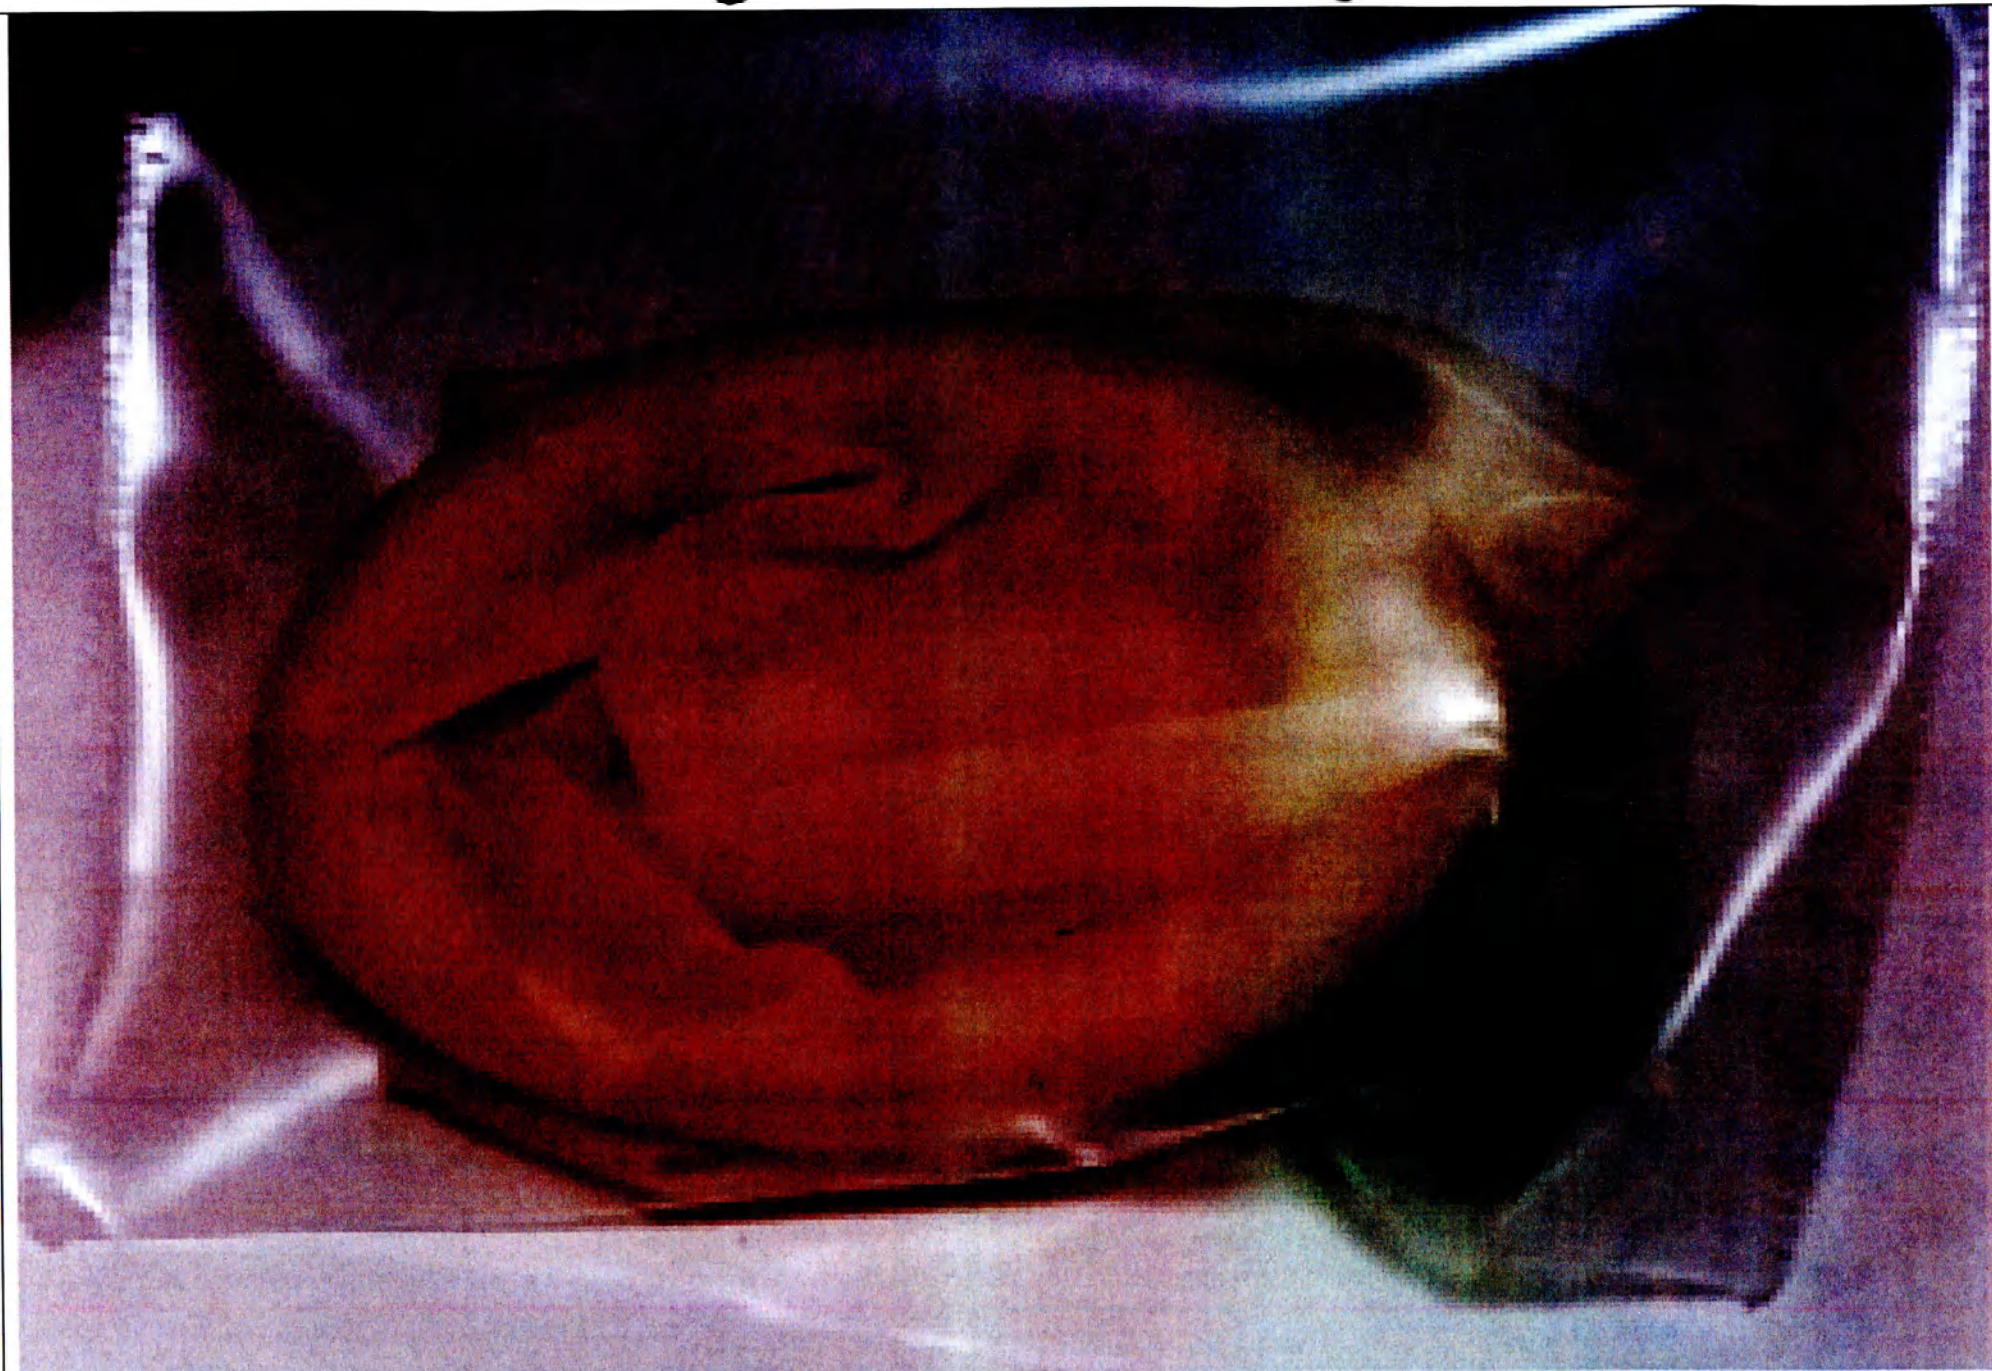


Рисунок 29. Защитные нестерильные оболочки для датчиков



Рисунок 30. Ножной переключатель с двумя педалями

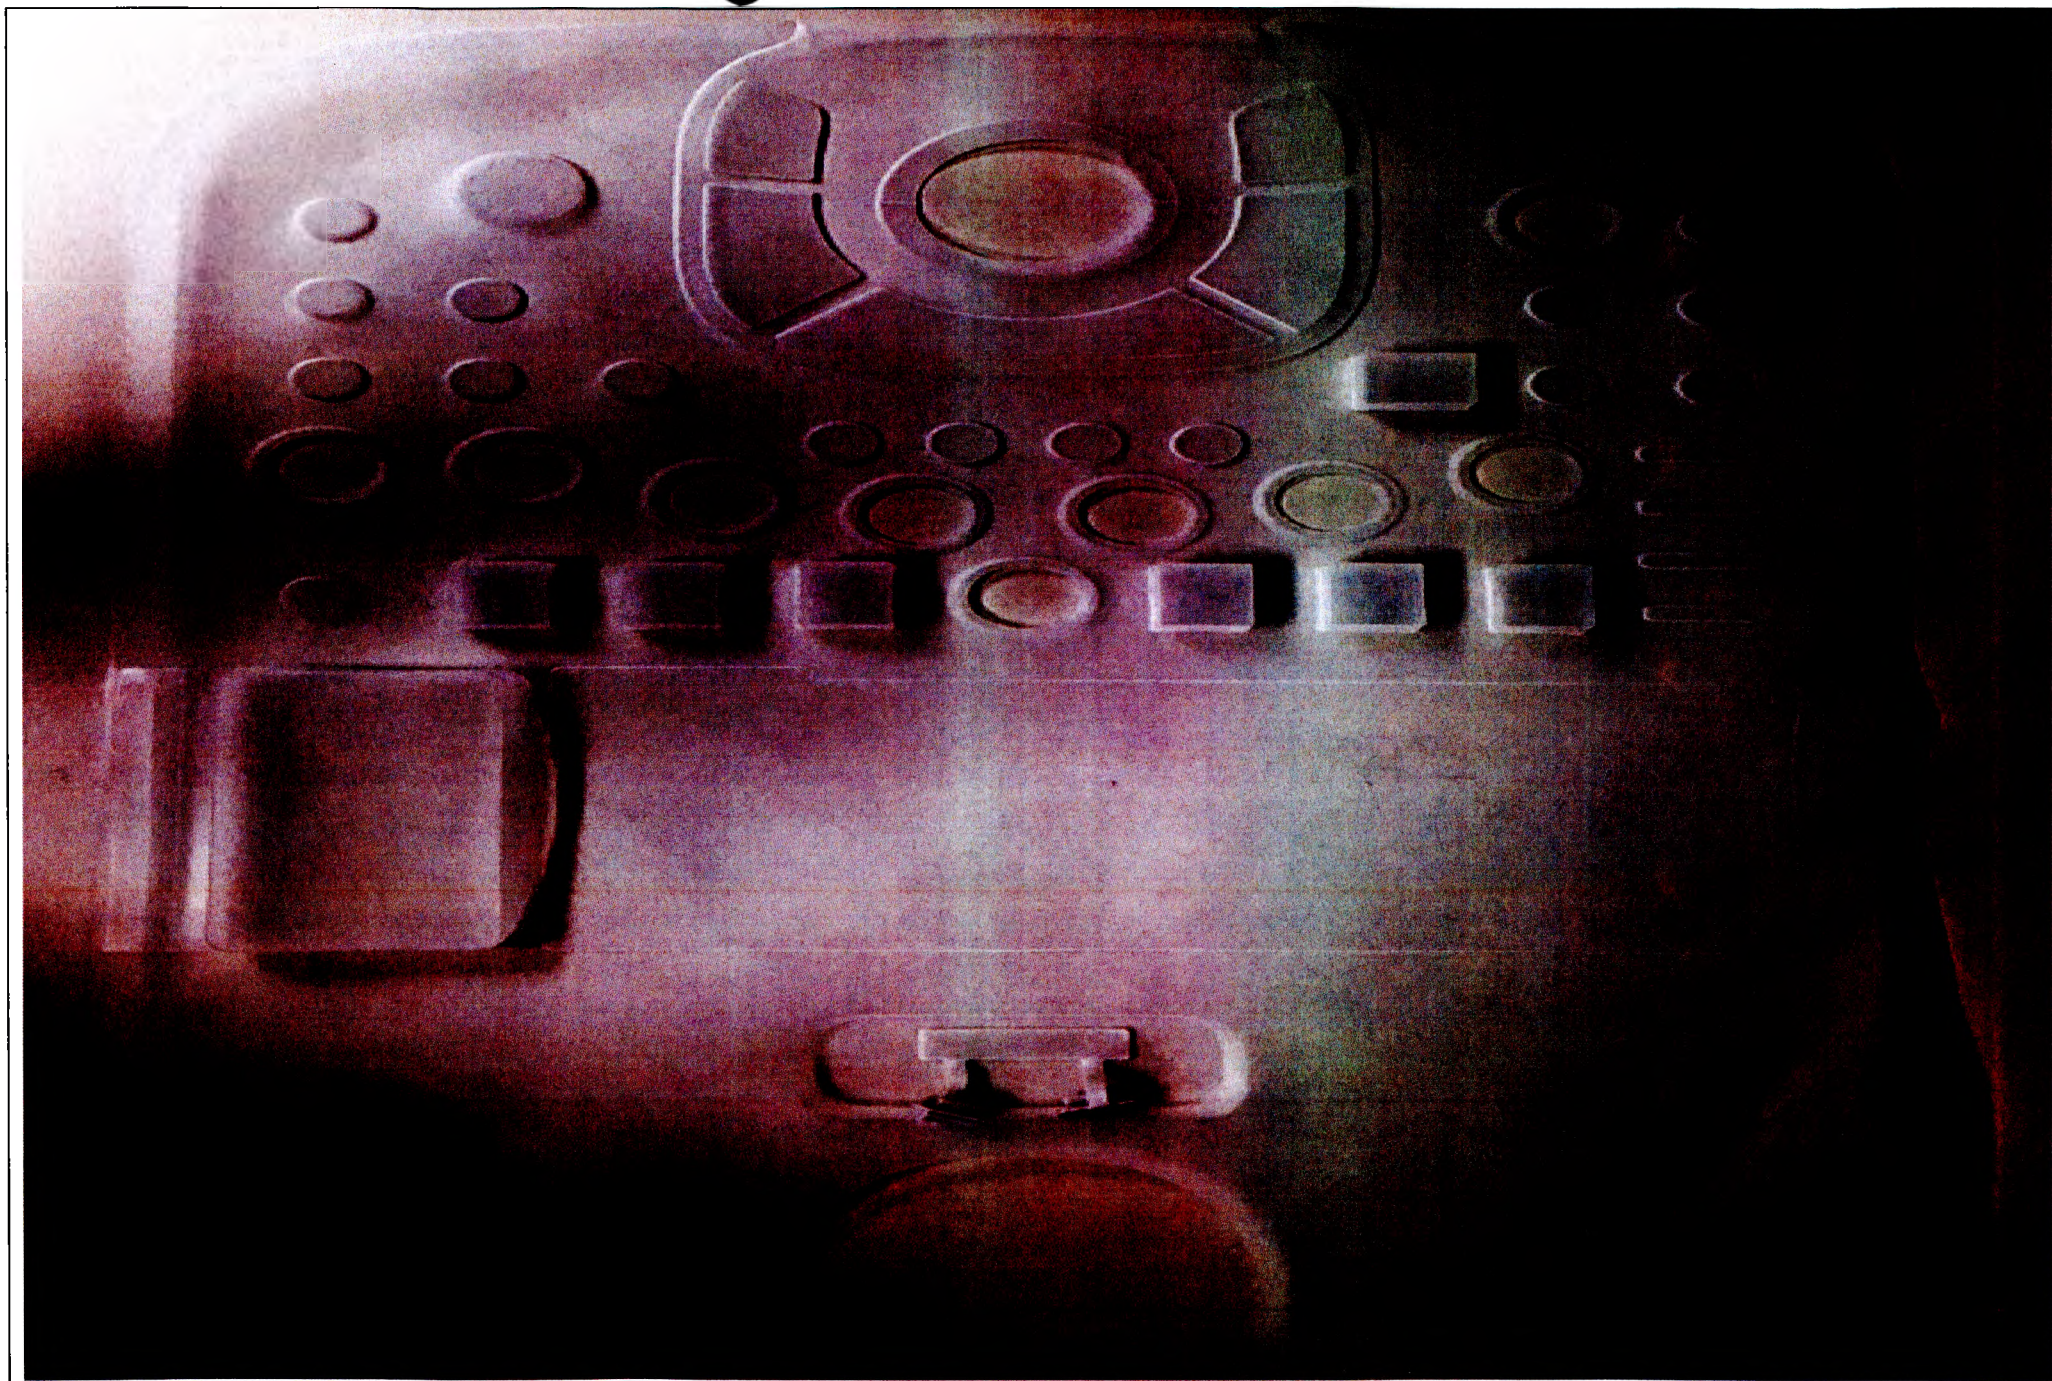


Рисунок 31. Защитная накладка для панели управления

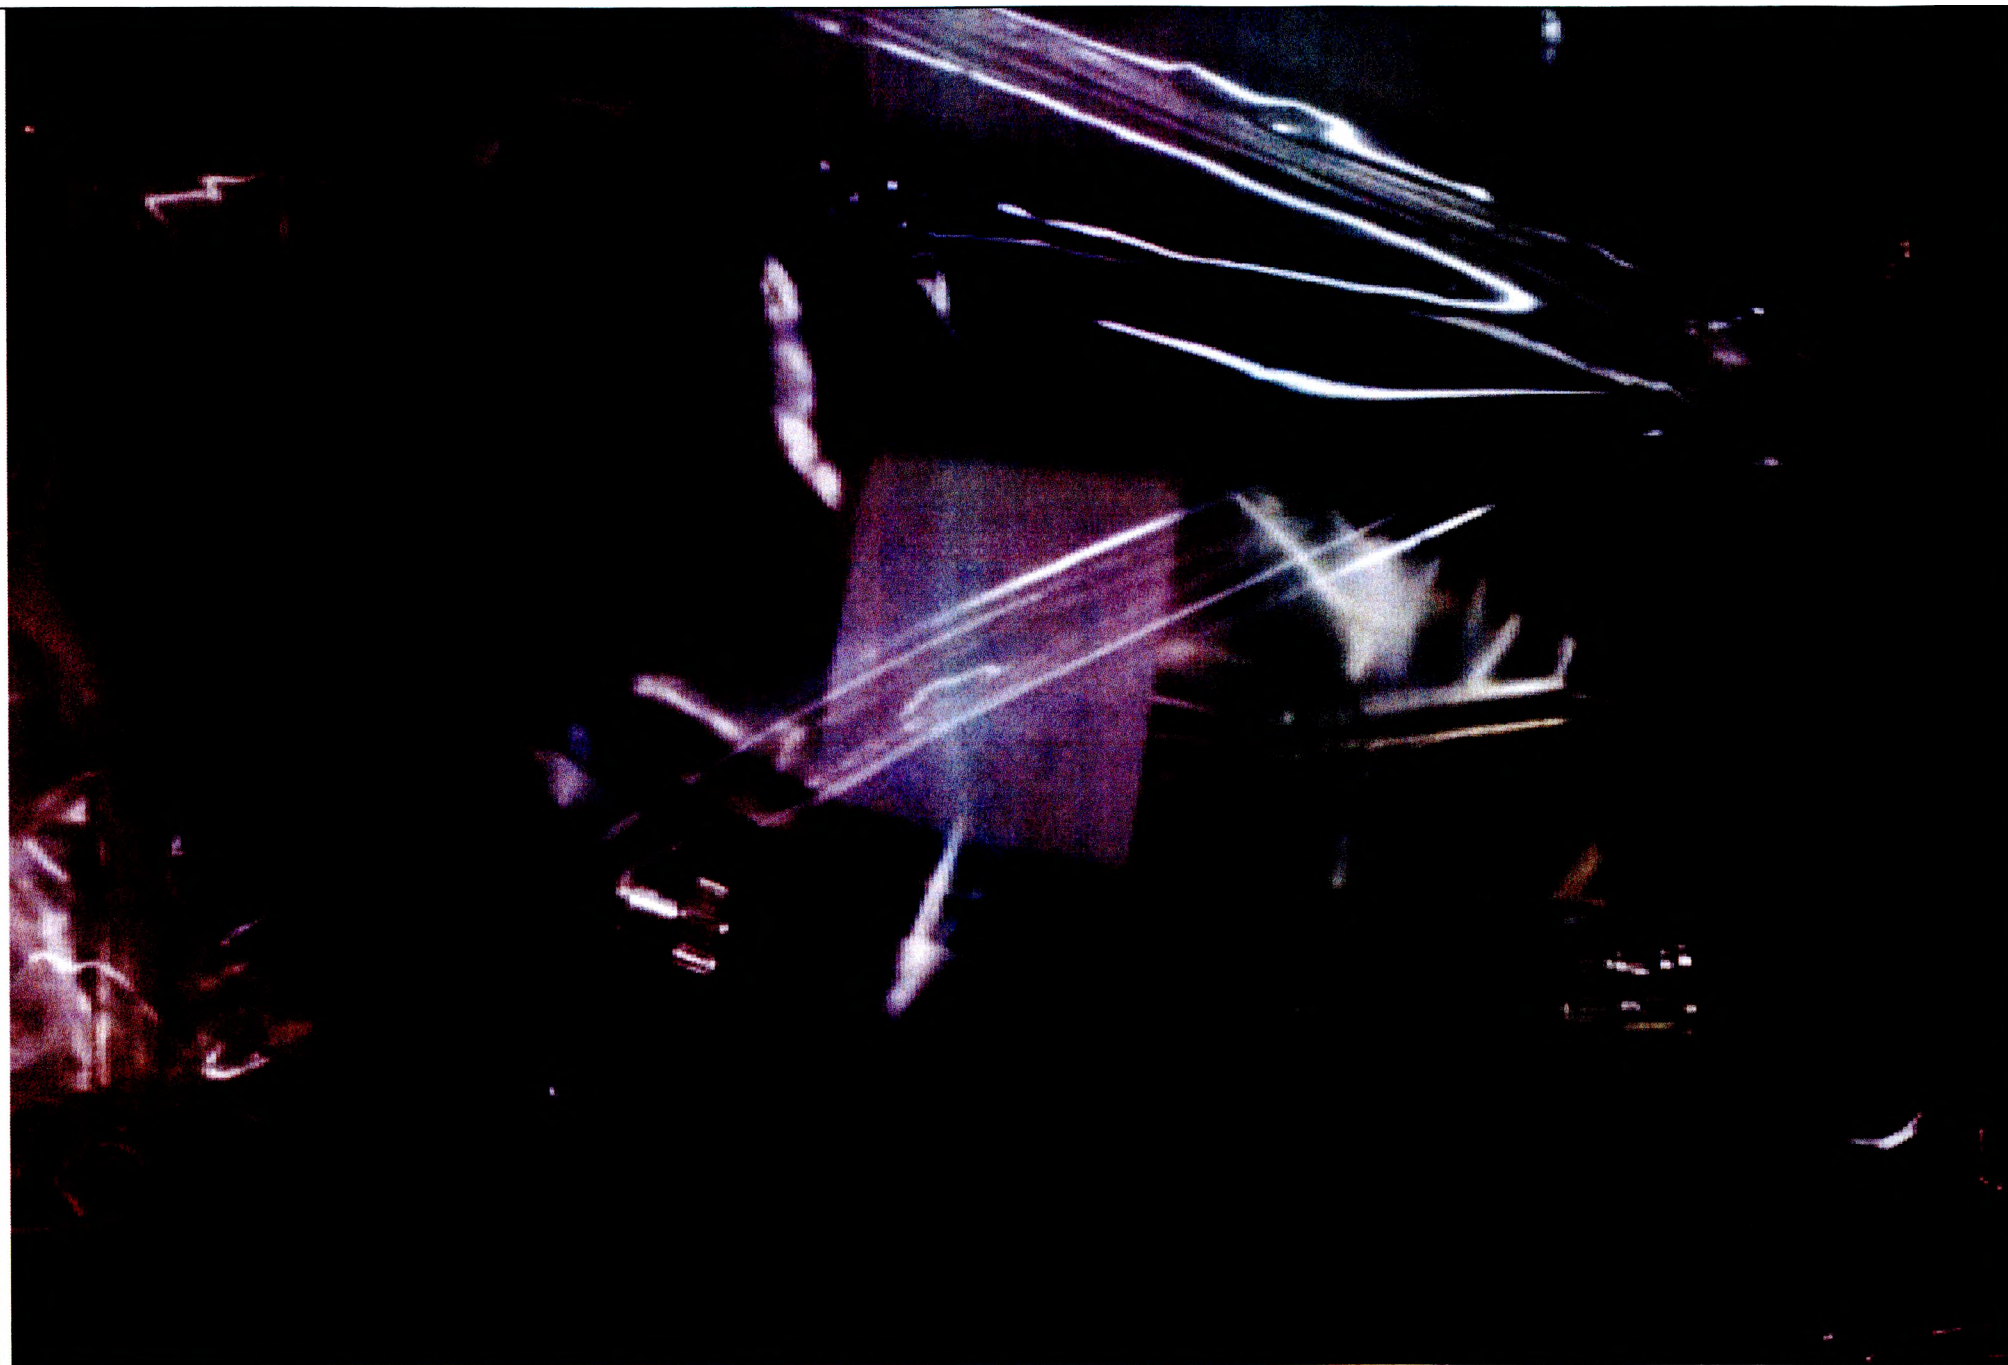


Рисунок 32. Кабель с адаптером для проведения стресс - эхокардиографии

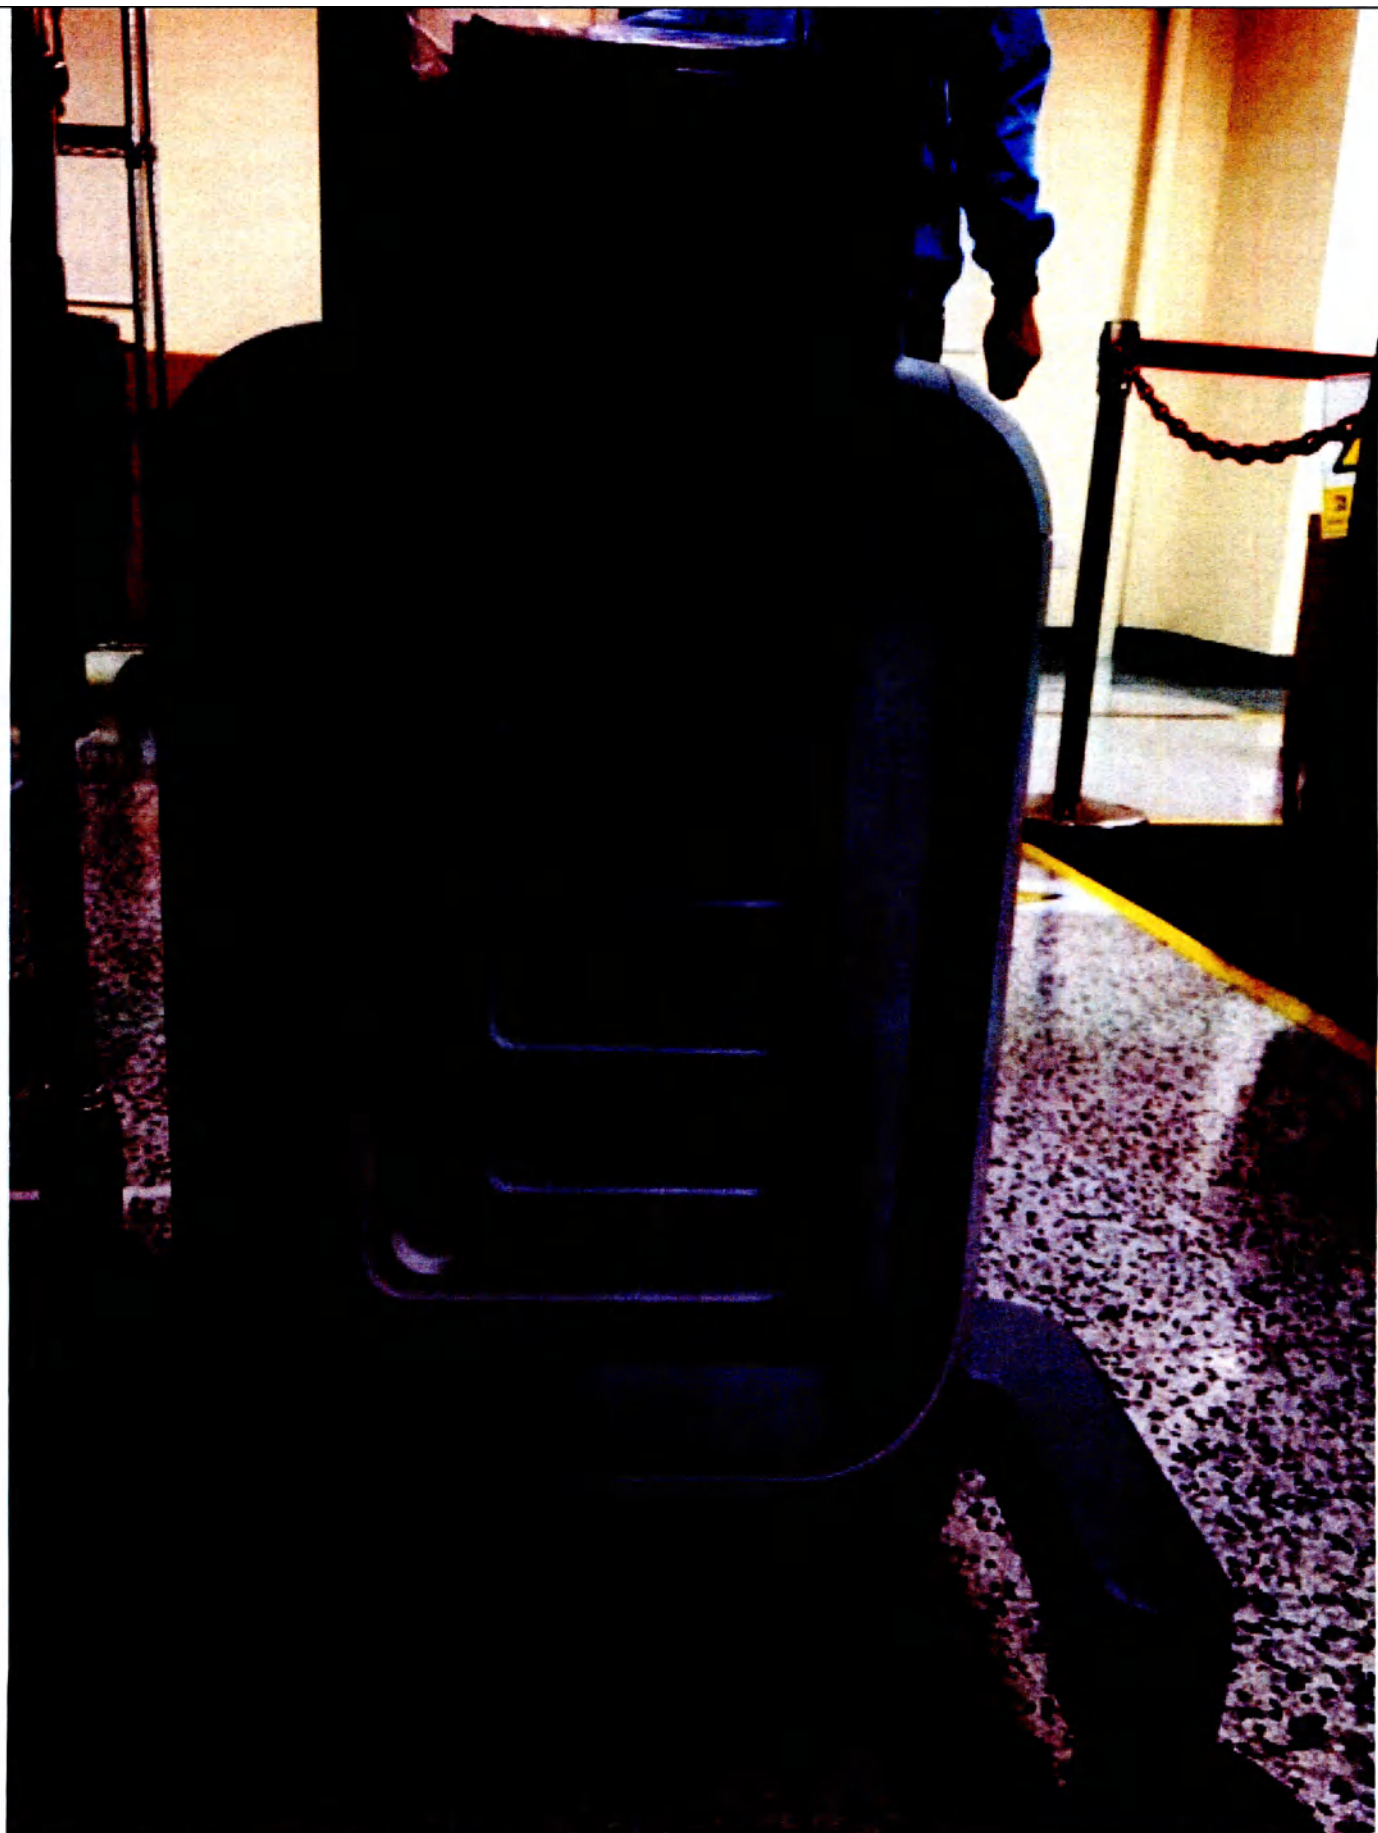



Рисунок 33. Устройства для установки периферийного оборудования



Рисунок 34. Одноразовая гелевая прокладка для линейных датчиков



Рисунок 35. Бумага для печати медицинских изображений

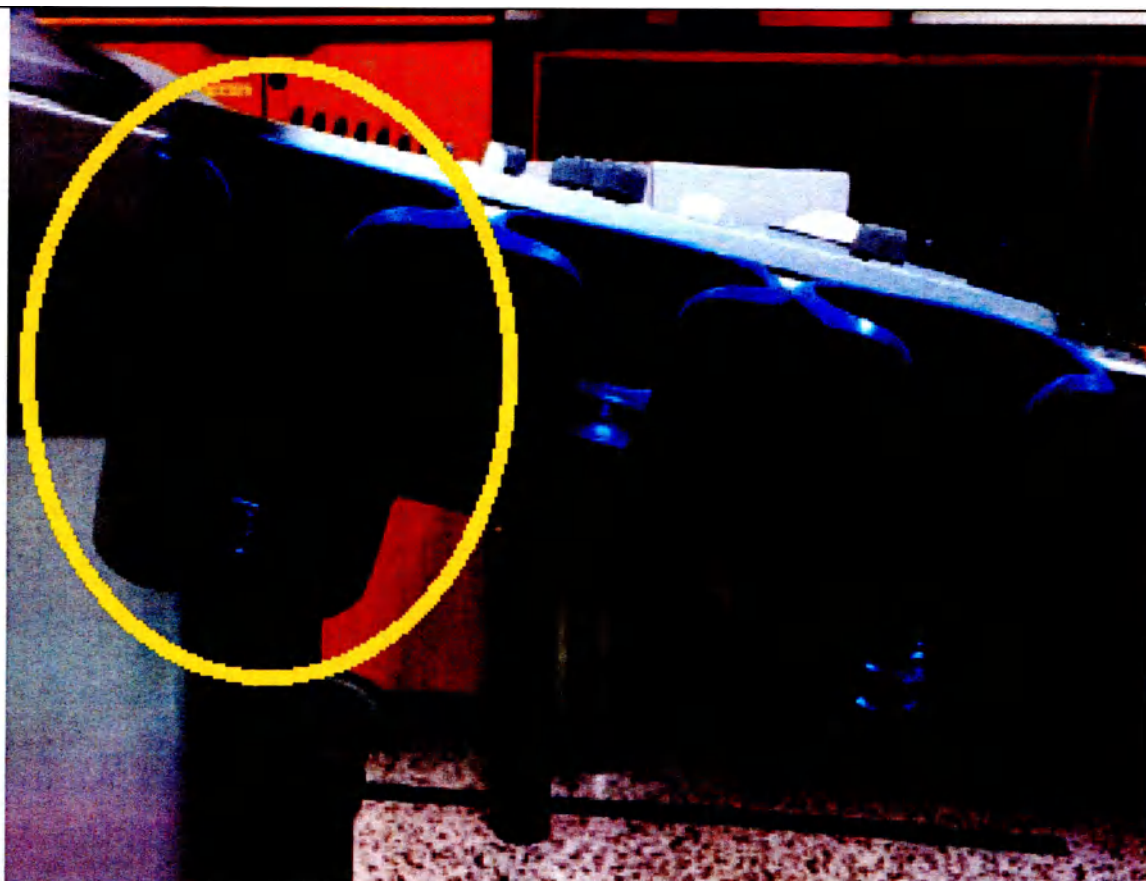

ASSEMBLY PROBE LONG



ASSEMBLY PROBE SHORT

Рисунок 36. Держатели для датчиков



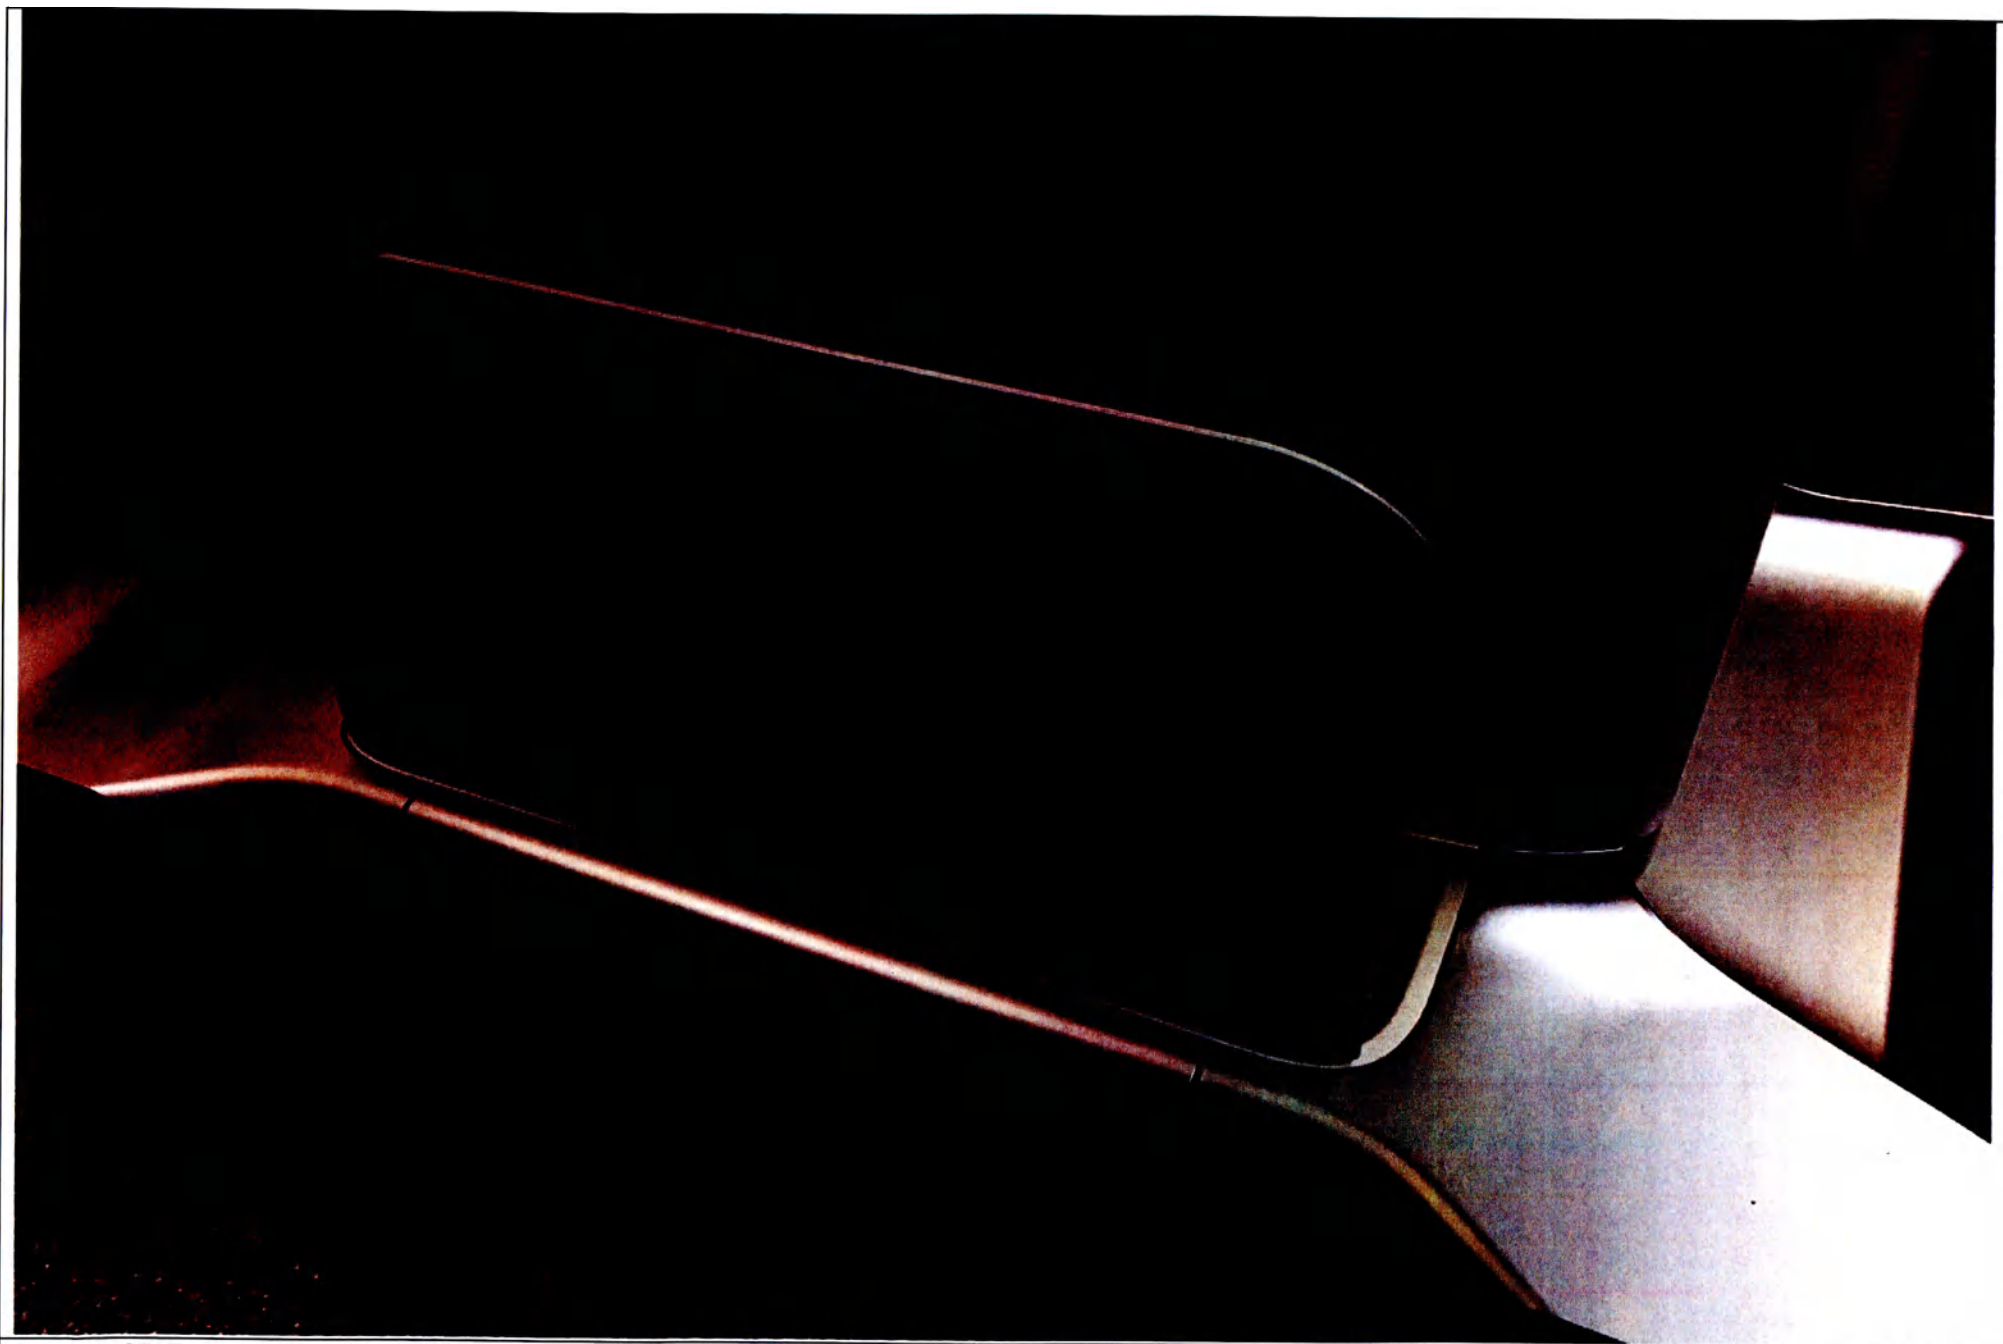


Рисунок 37. Боковой контейнер для хранения принадлежностей

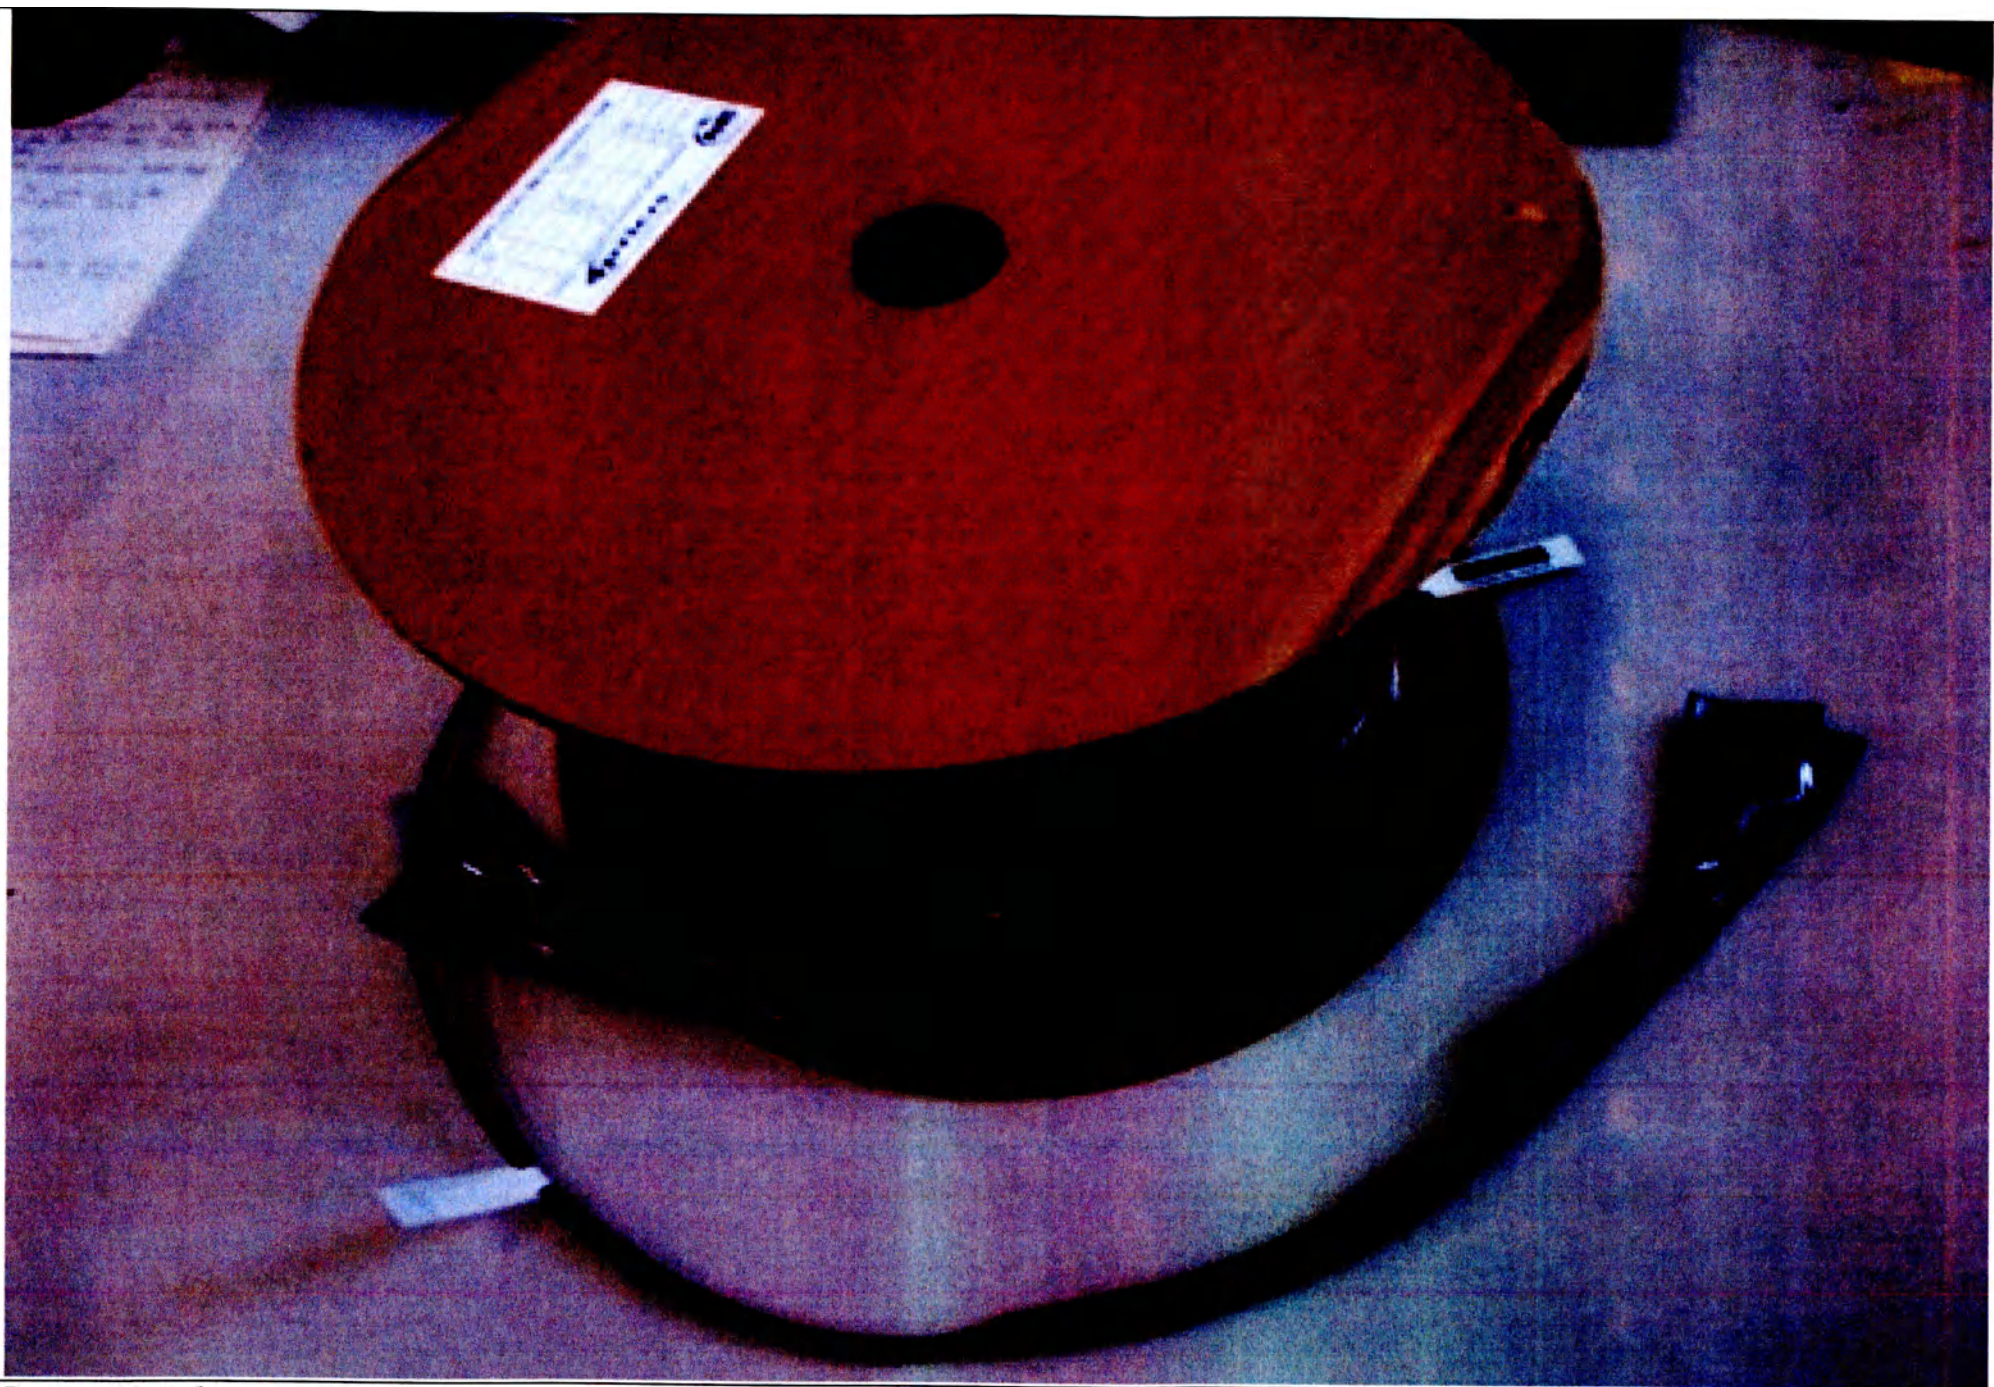

Фотографические изображения принадлежностей медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая, вариант исполнения: ACUSON NX2 Elite»

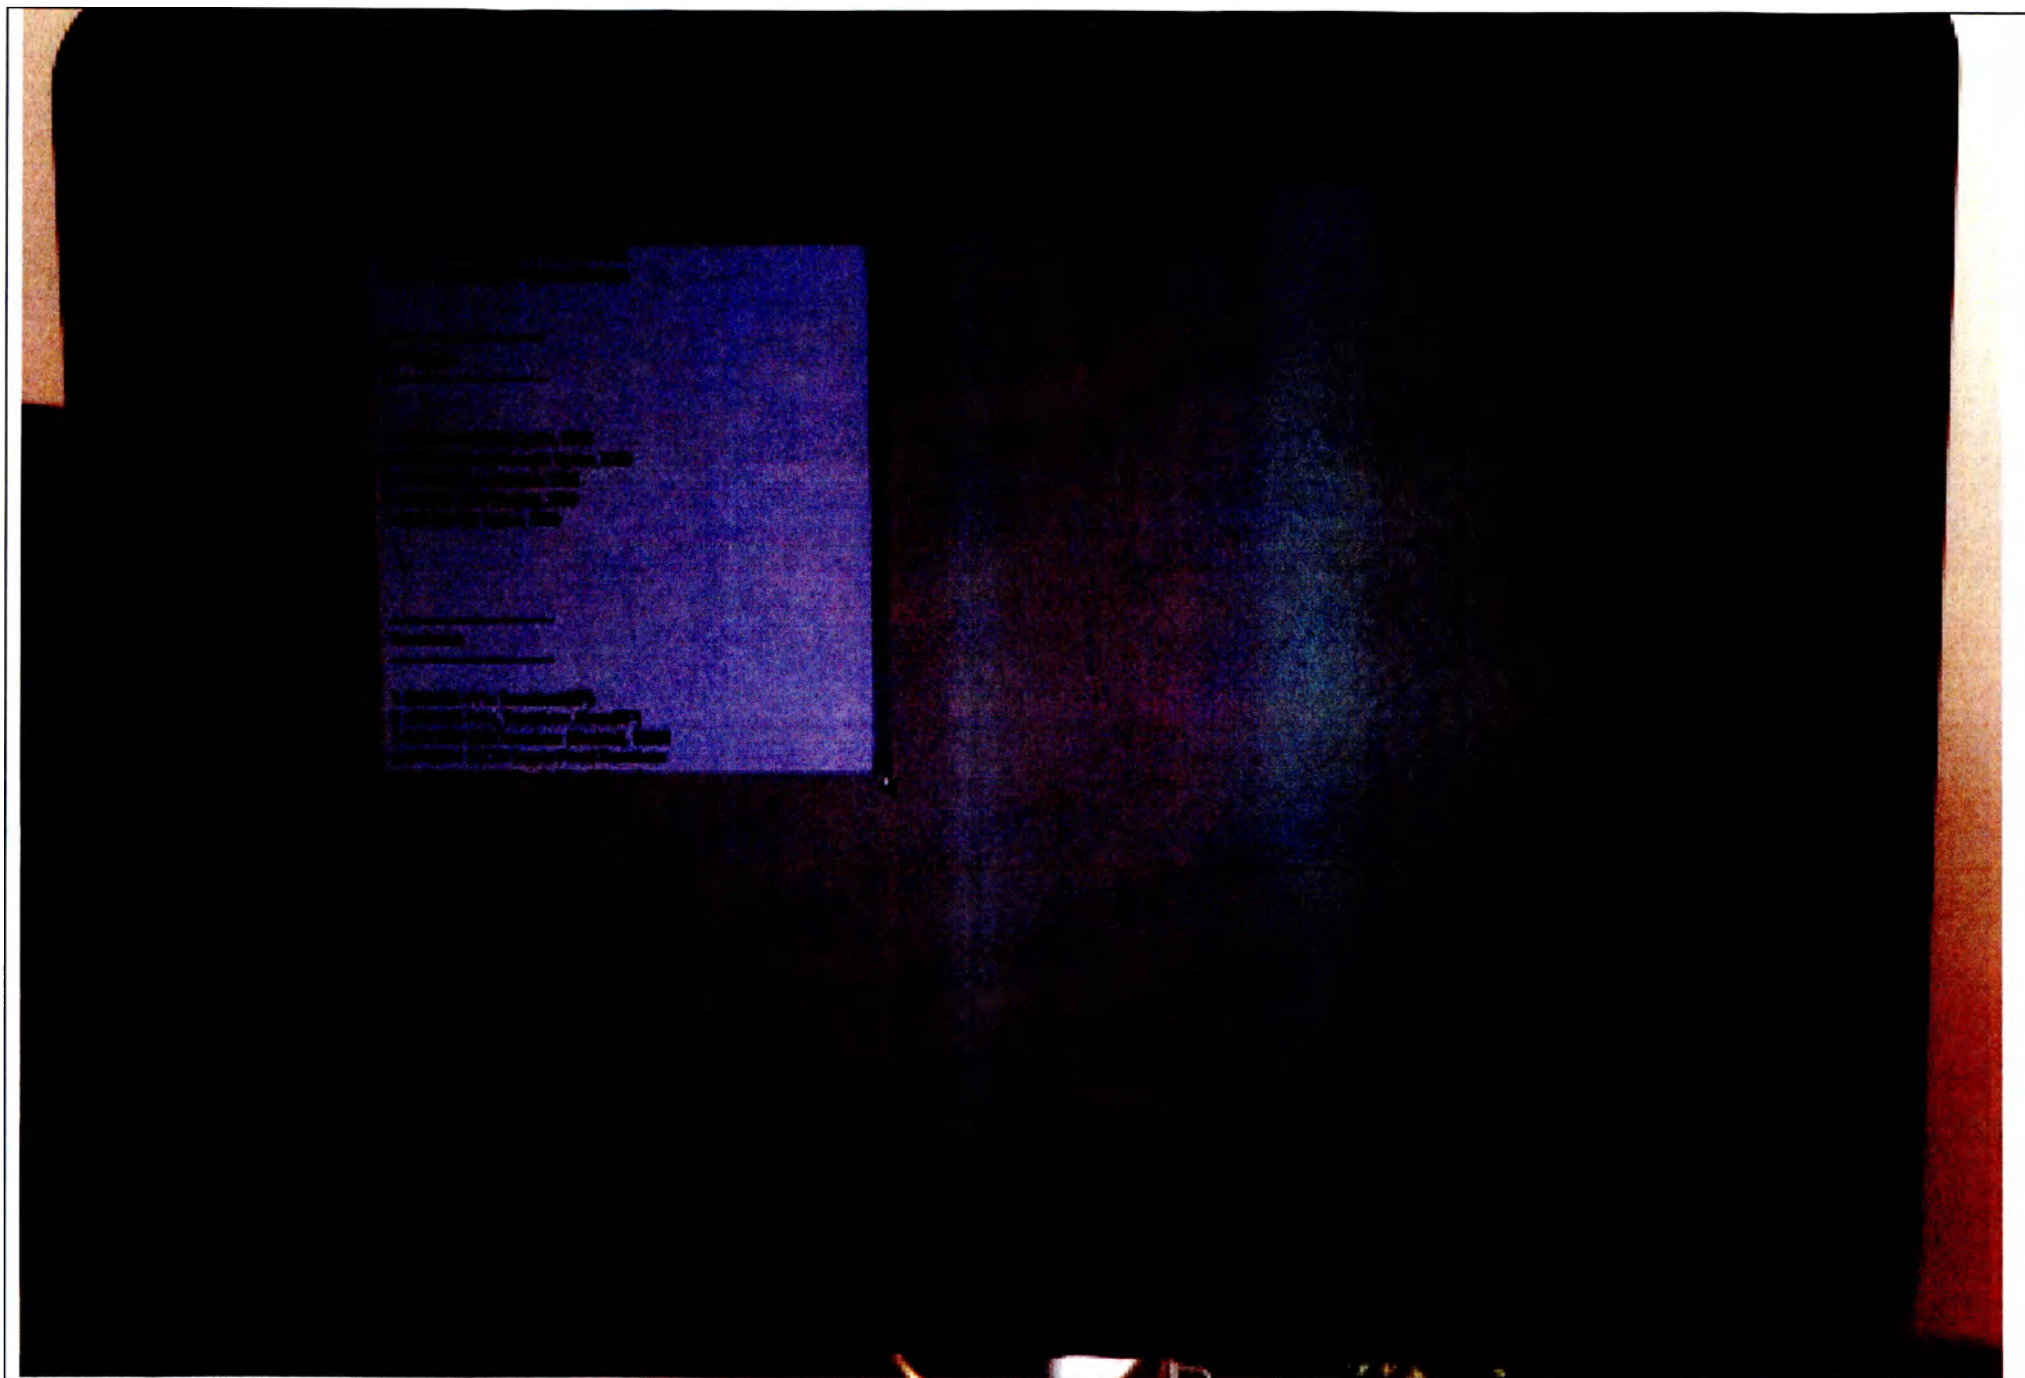

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM**
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | **Storage Server** | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Local Host ☒ Show network status

Alias: Default

AE Title: Default

Host Name: Default

MAC Address: 00-19-0F-23-2C-DE

New Edit Delete

☐ DHCP

☐ Mapping Application

☒ Fixed IP address

IP Address: 192 168 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 0 0 0 0

Media Type: HardwareDefault

Duplex Mode: HardwareDefault

Save Cancel

Рисунок 2. Лицензионный ключ для функции передачи данных по стандарту DICOM (передача данных на хранение в сеть, отправка и запрос рабочих списков DICOM, отправка и запрос процедур для пациента из информационной сети учреждения DICOM MPPS) на оптическом и/или электронном носителе.

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worldist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Storage Server ☐ Uses Commitment☒ SS_AL

Alias: SS_AL

AE Title: SS_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM☐ Store During Exam☒ Store At End Of Exam☐ After Every Image is Stored☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure:

2

Seconds Between Each Retry:

60

Write Timeout in Seconds:

30

Connect Timeout in Seconds:

30

Image Format:

Automatic

☒ Send SR☒ No Monochrome conversion☐ Store all images as Monochrome☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

Рисунок 3. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для акушерских/гинекологических исследований на оптическом

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | WorldNet Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Storage Server ☐ Uses Commitment☒ SS_AL

Alias: SS_AL

AE Title: SS_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM☐ Store During Exam☒ Store At End Of Exam☐ After Every Image is Stored☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic

☒ Send SR☒ No Monochrome conversion☐ Store all images as Monochrome☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

Local Host | Storage Server | Worldnet Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Storage Server ☐ Uses Commitment

☒ SS_AL

Alias: SS_AL

AE Title: SS_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM

☐ Store During Exam

☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored

☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic

☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

носителя.

VF10-5

MSK

32 dB

10.0 MHz

DR 60 dB

Edge 3

Persist 4

R S 3

Map E

Tint 0

38 fps

TGO™ tissue grayscale optimization technology

015 2
Abdomen
30 dB
11.1 2.2 MHz
DR 60 dB
Edge 2
Persist 4
R/S 4
Map 0
Tint 0
4 fps

Tissue Harmonic Imaging
Hemangioma Seen Within Liver

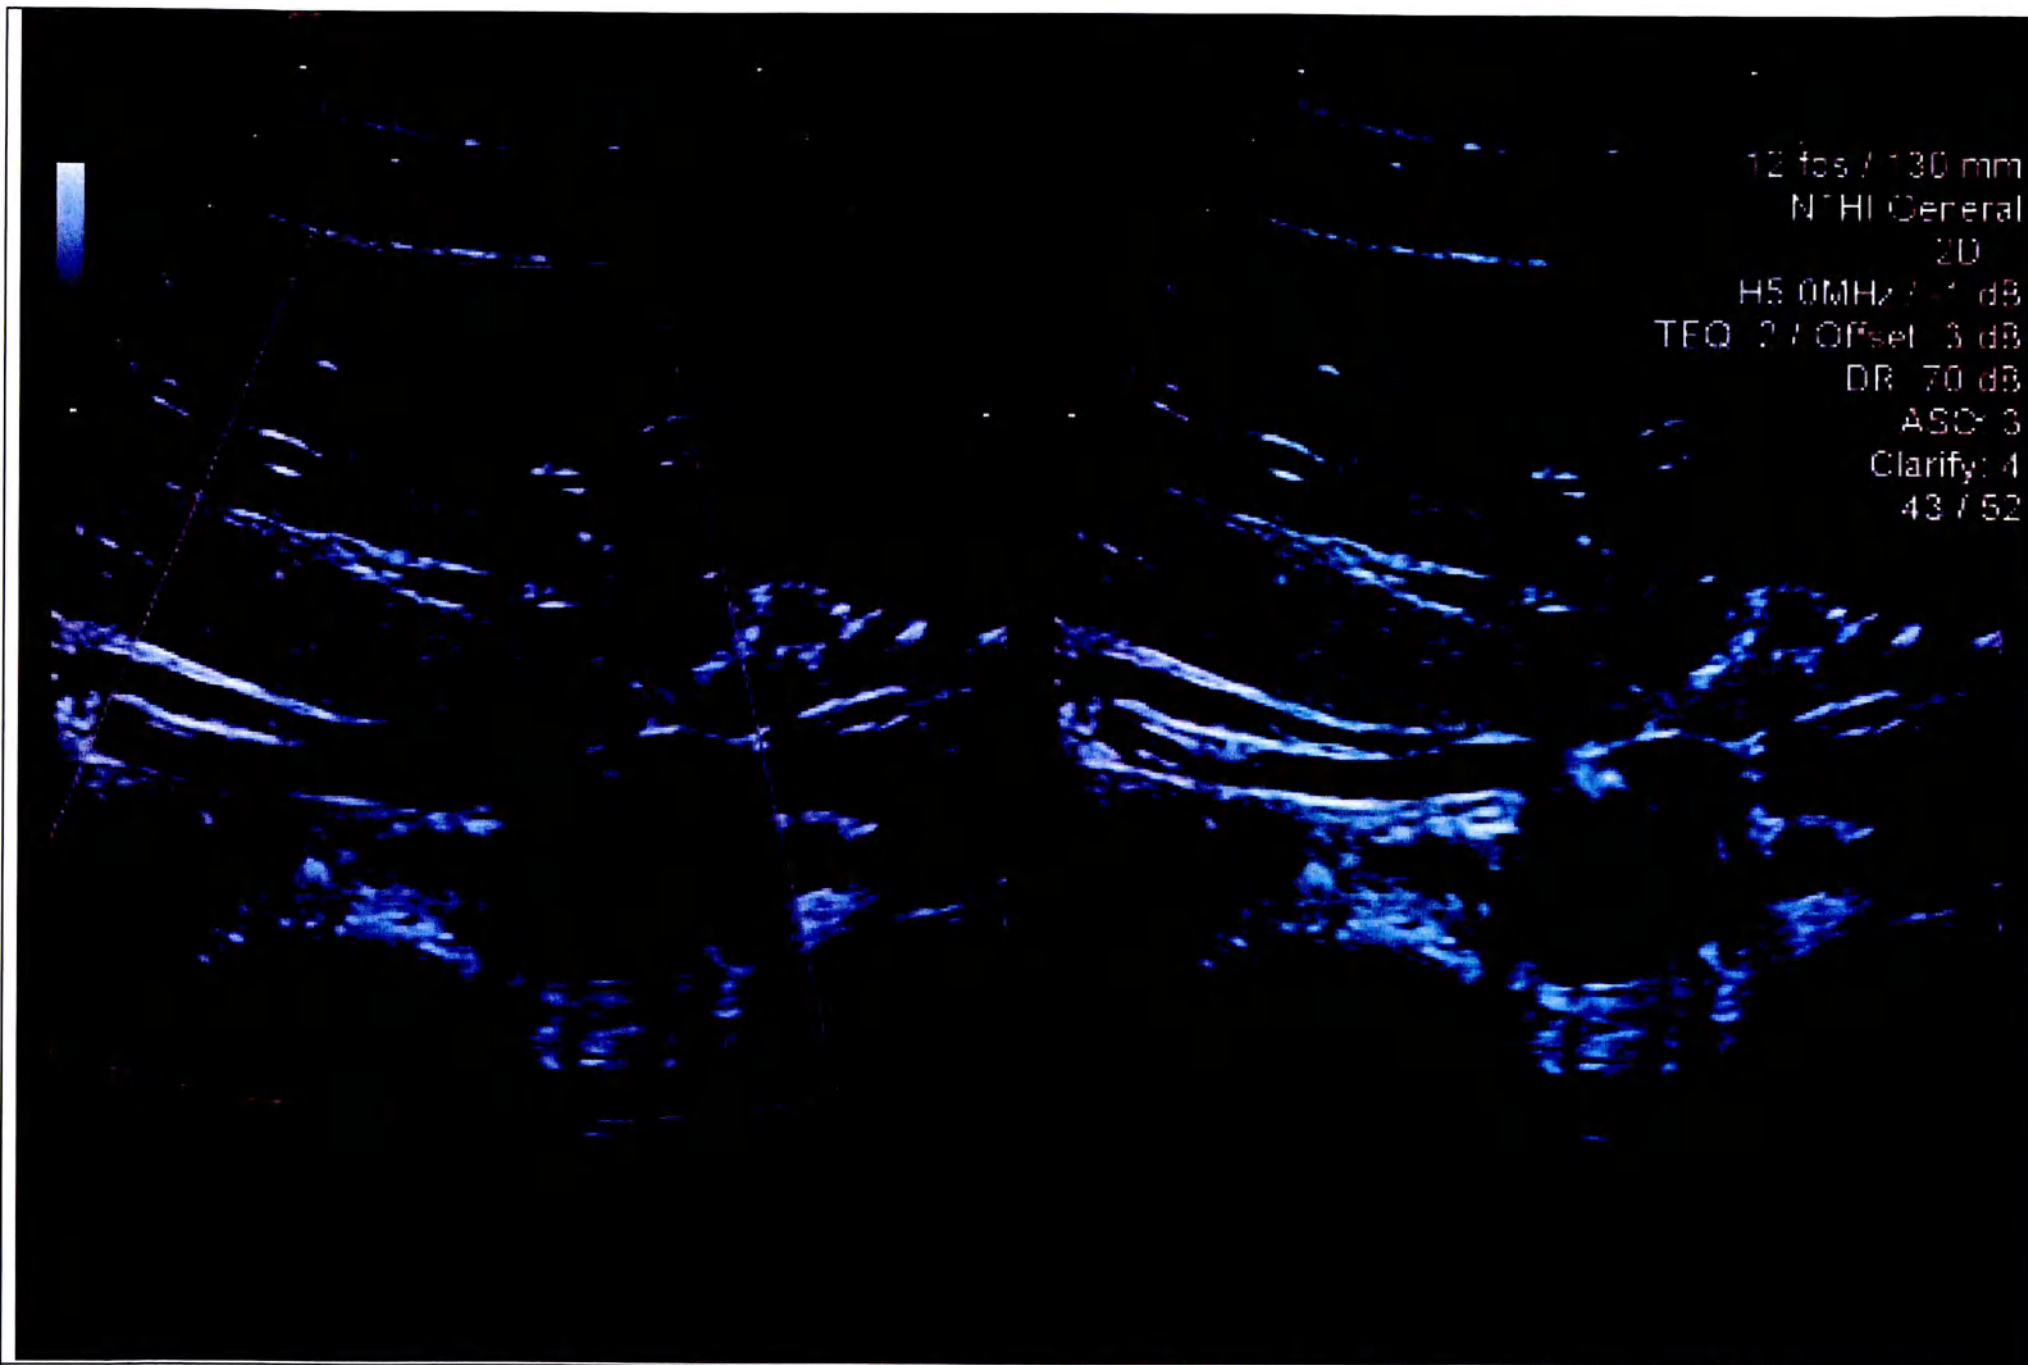


Рисунок 9. Лицензионный ключ для функции повышения качества отображения сосудов (Clarify VE) на оптическом и/или электронном носителе.

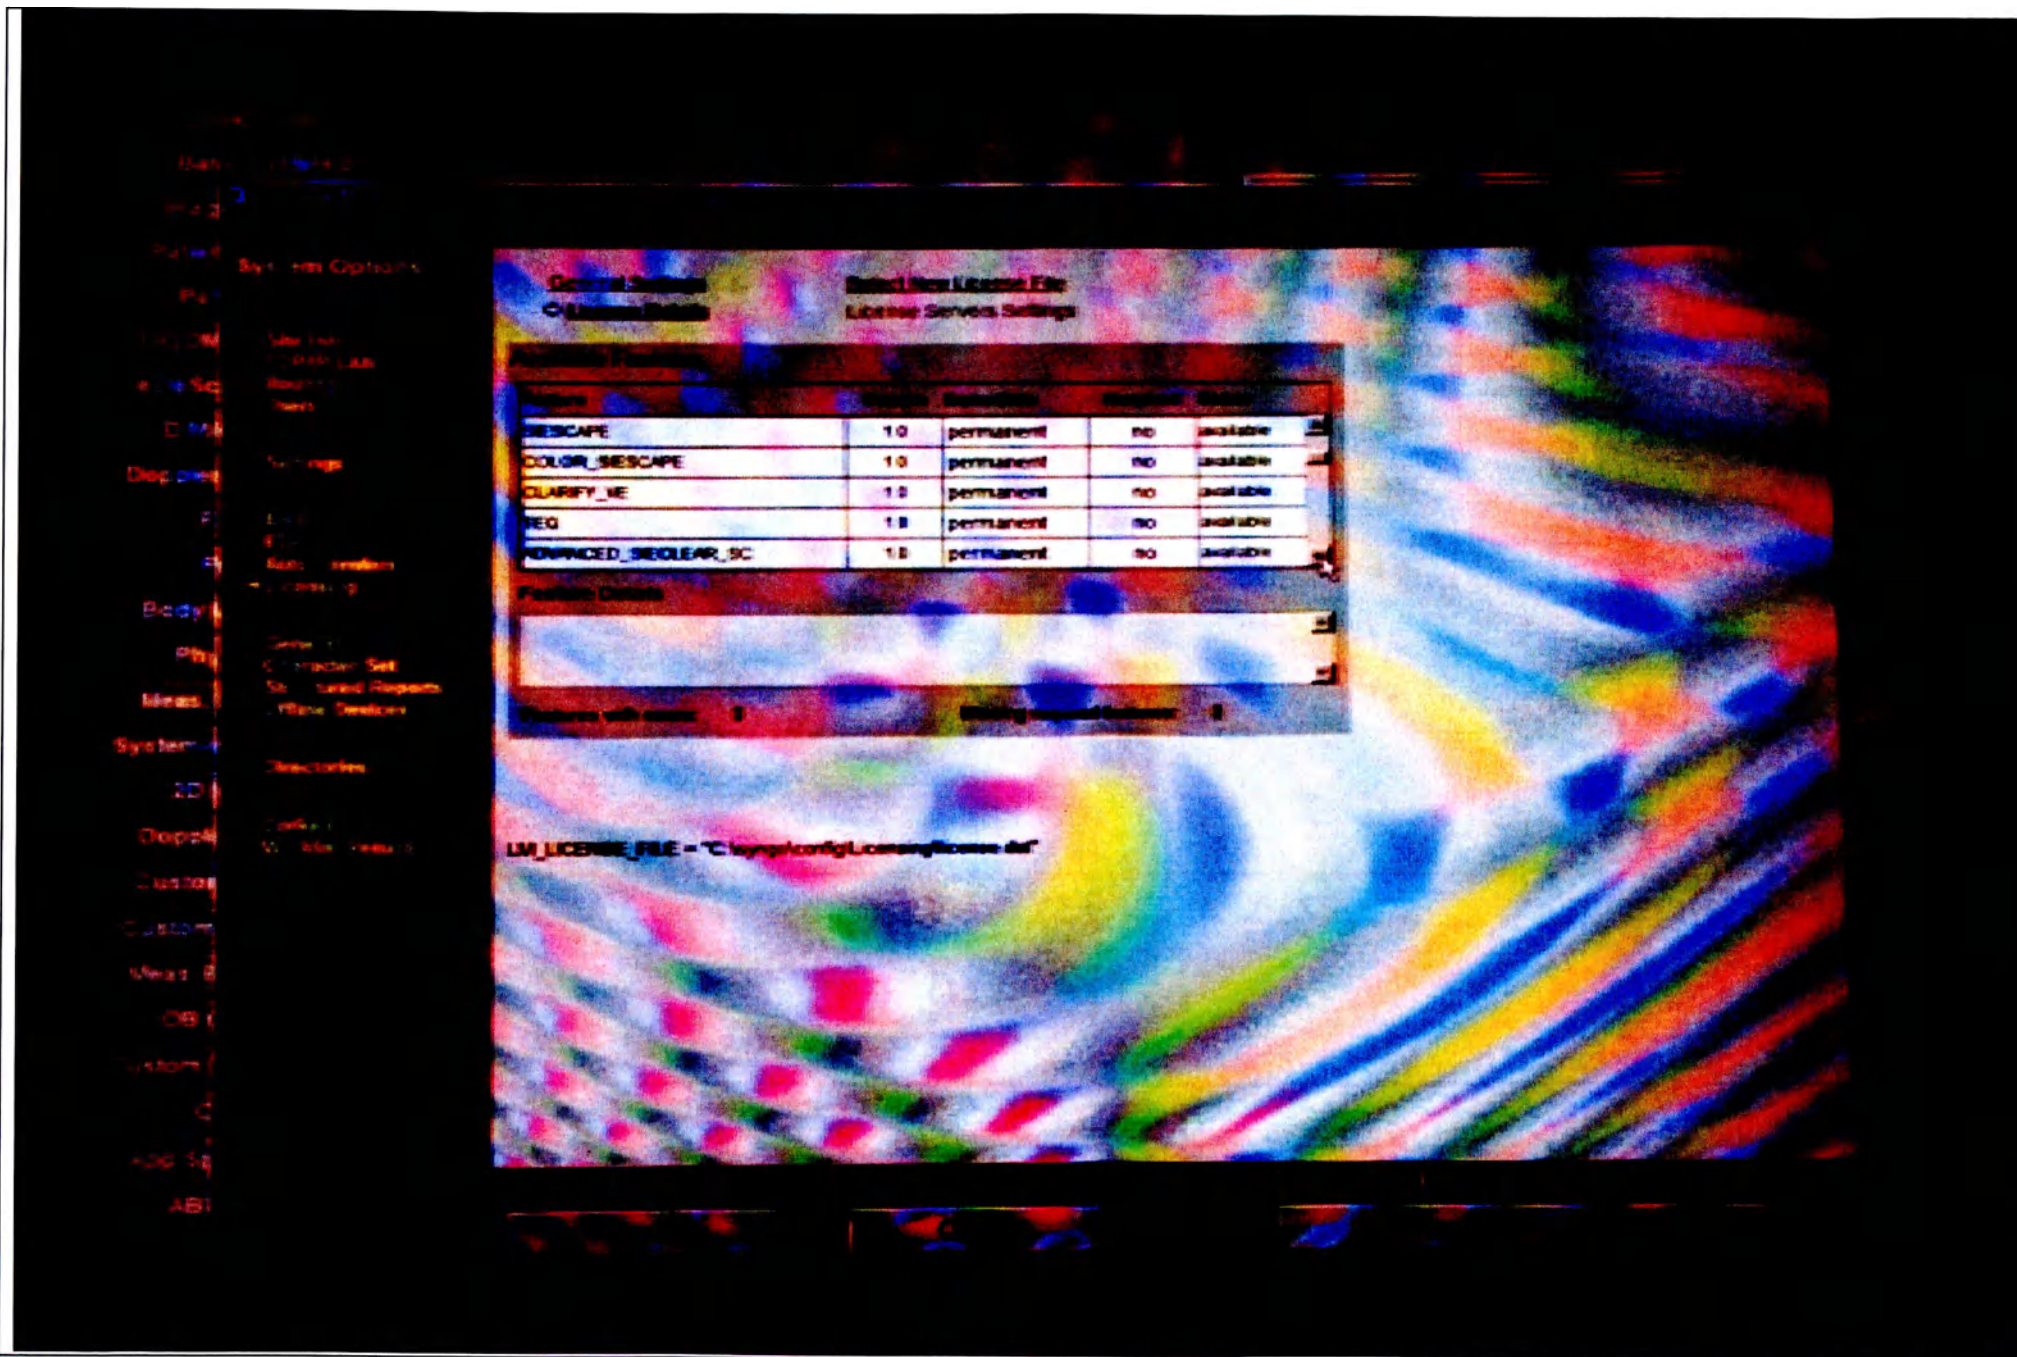


Рисунок 10. Лицензионный ключ для функции панорамной визуализации (SieScape) на оптическом и/или электронном носителе.

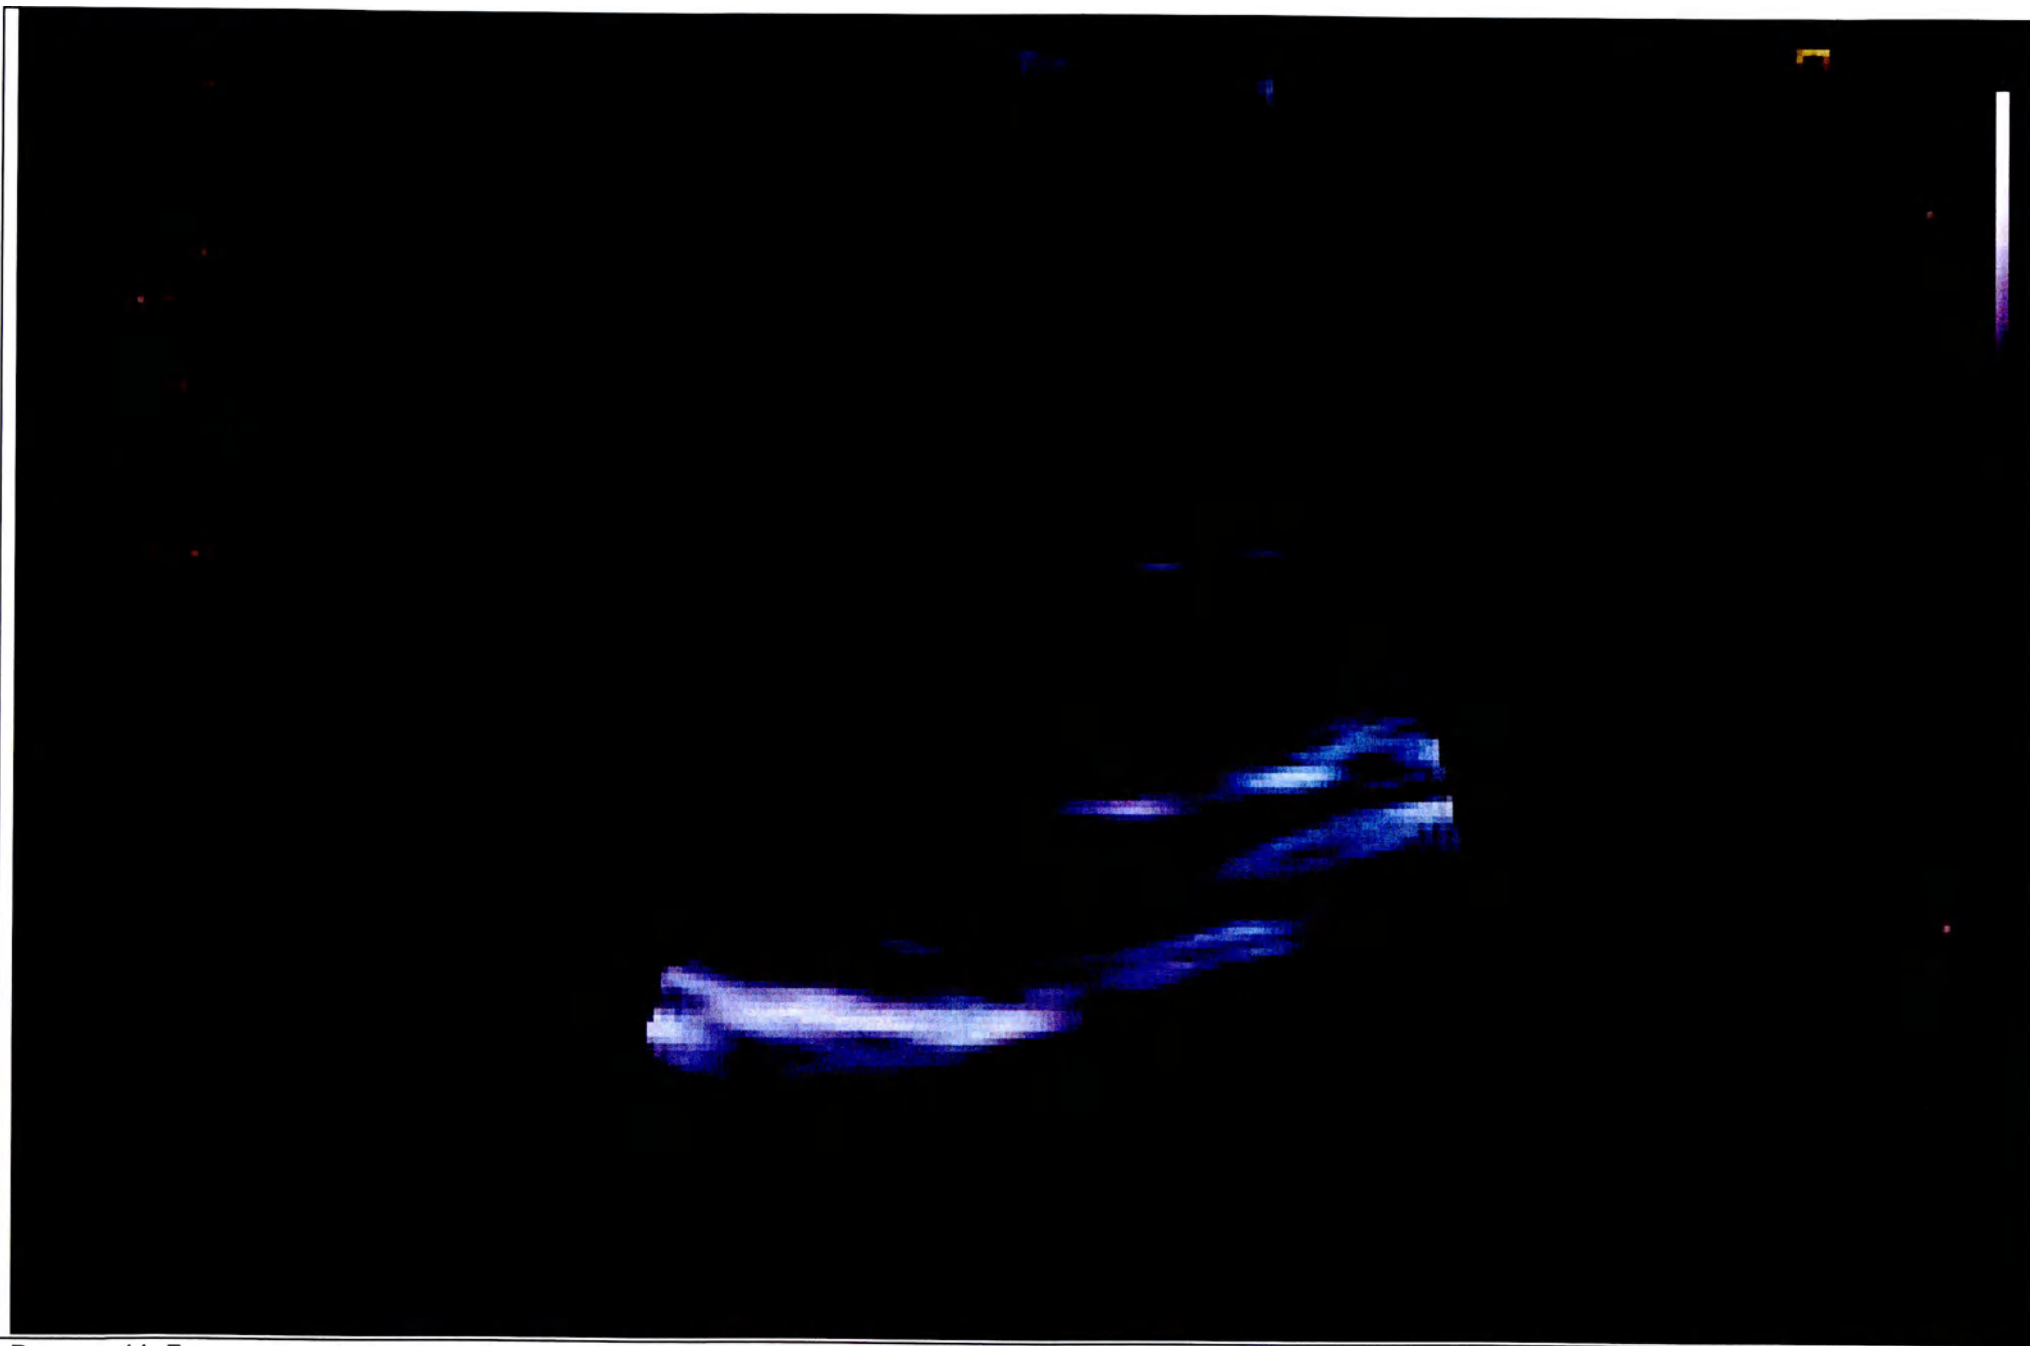


Рисунок 11. Лицензионный ключ для функции масштабирования с высоким разрешением (HD) на оптическом и/или электронном носителе.

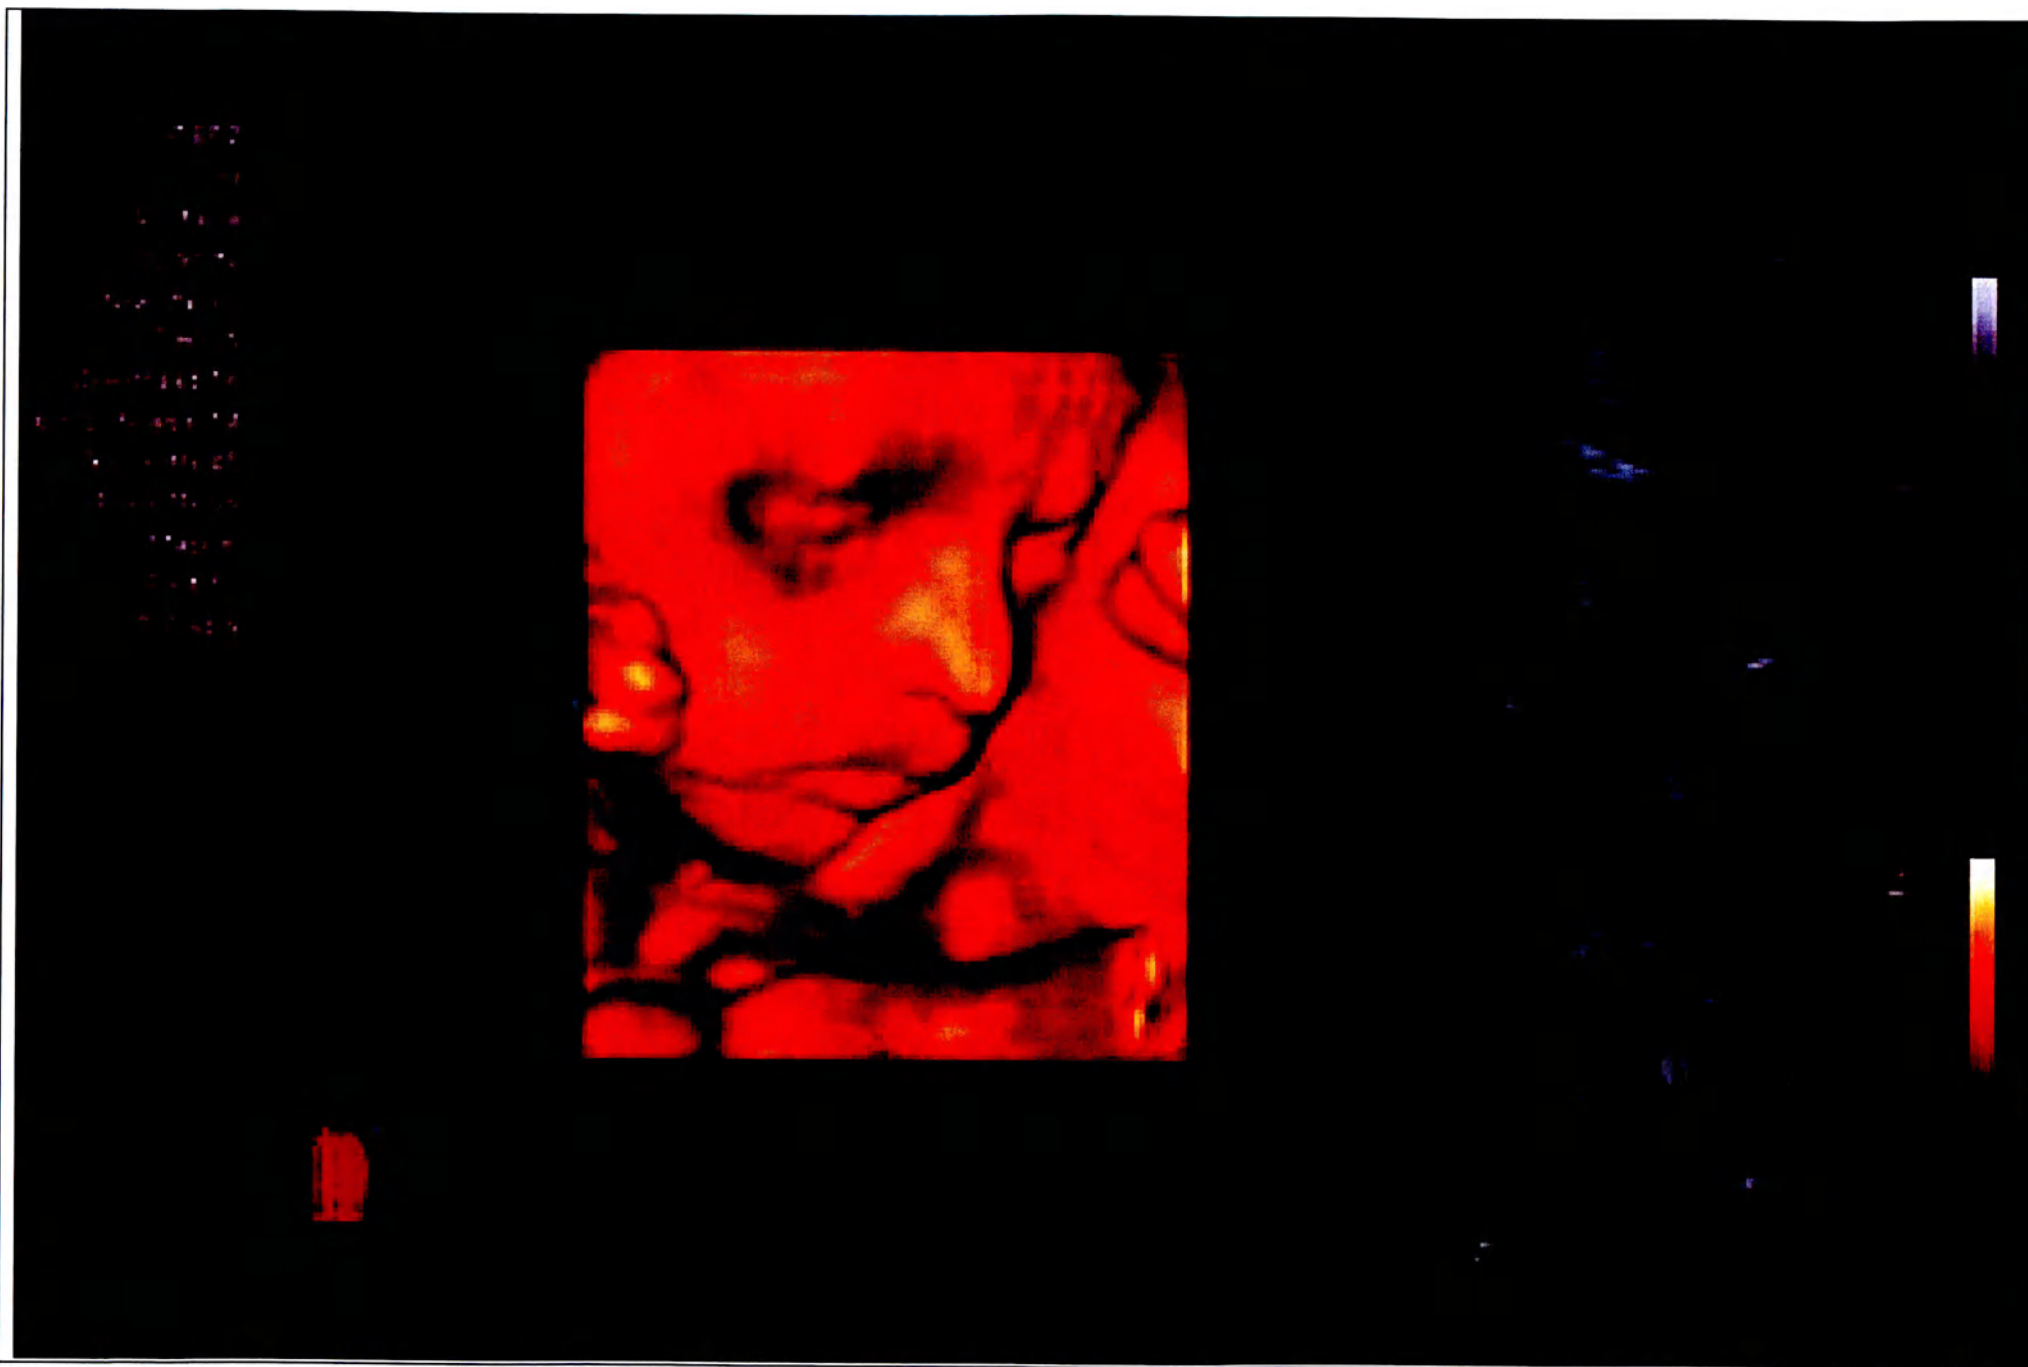


Рисунок 12. Лицензионный ключ для функции четырехмерной визуализации (fourSight 4D) на оптическом и/или электронном носителе.



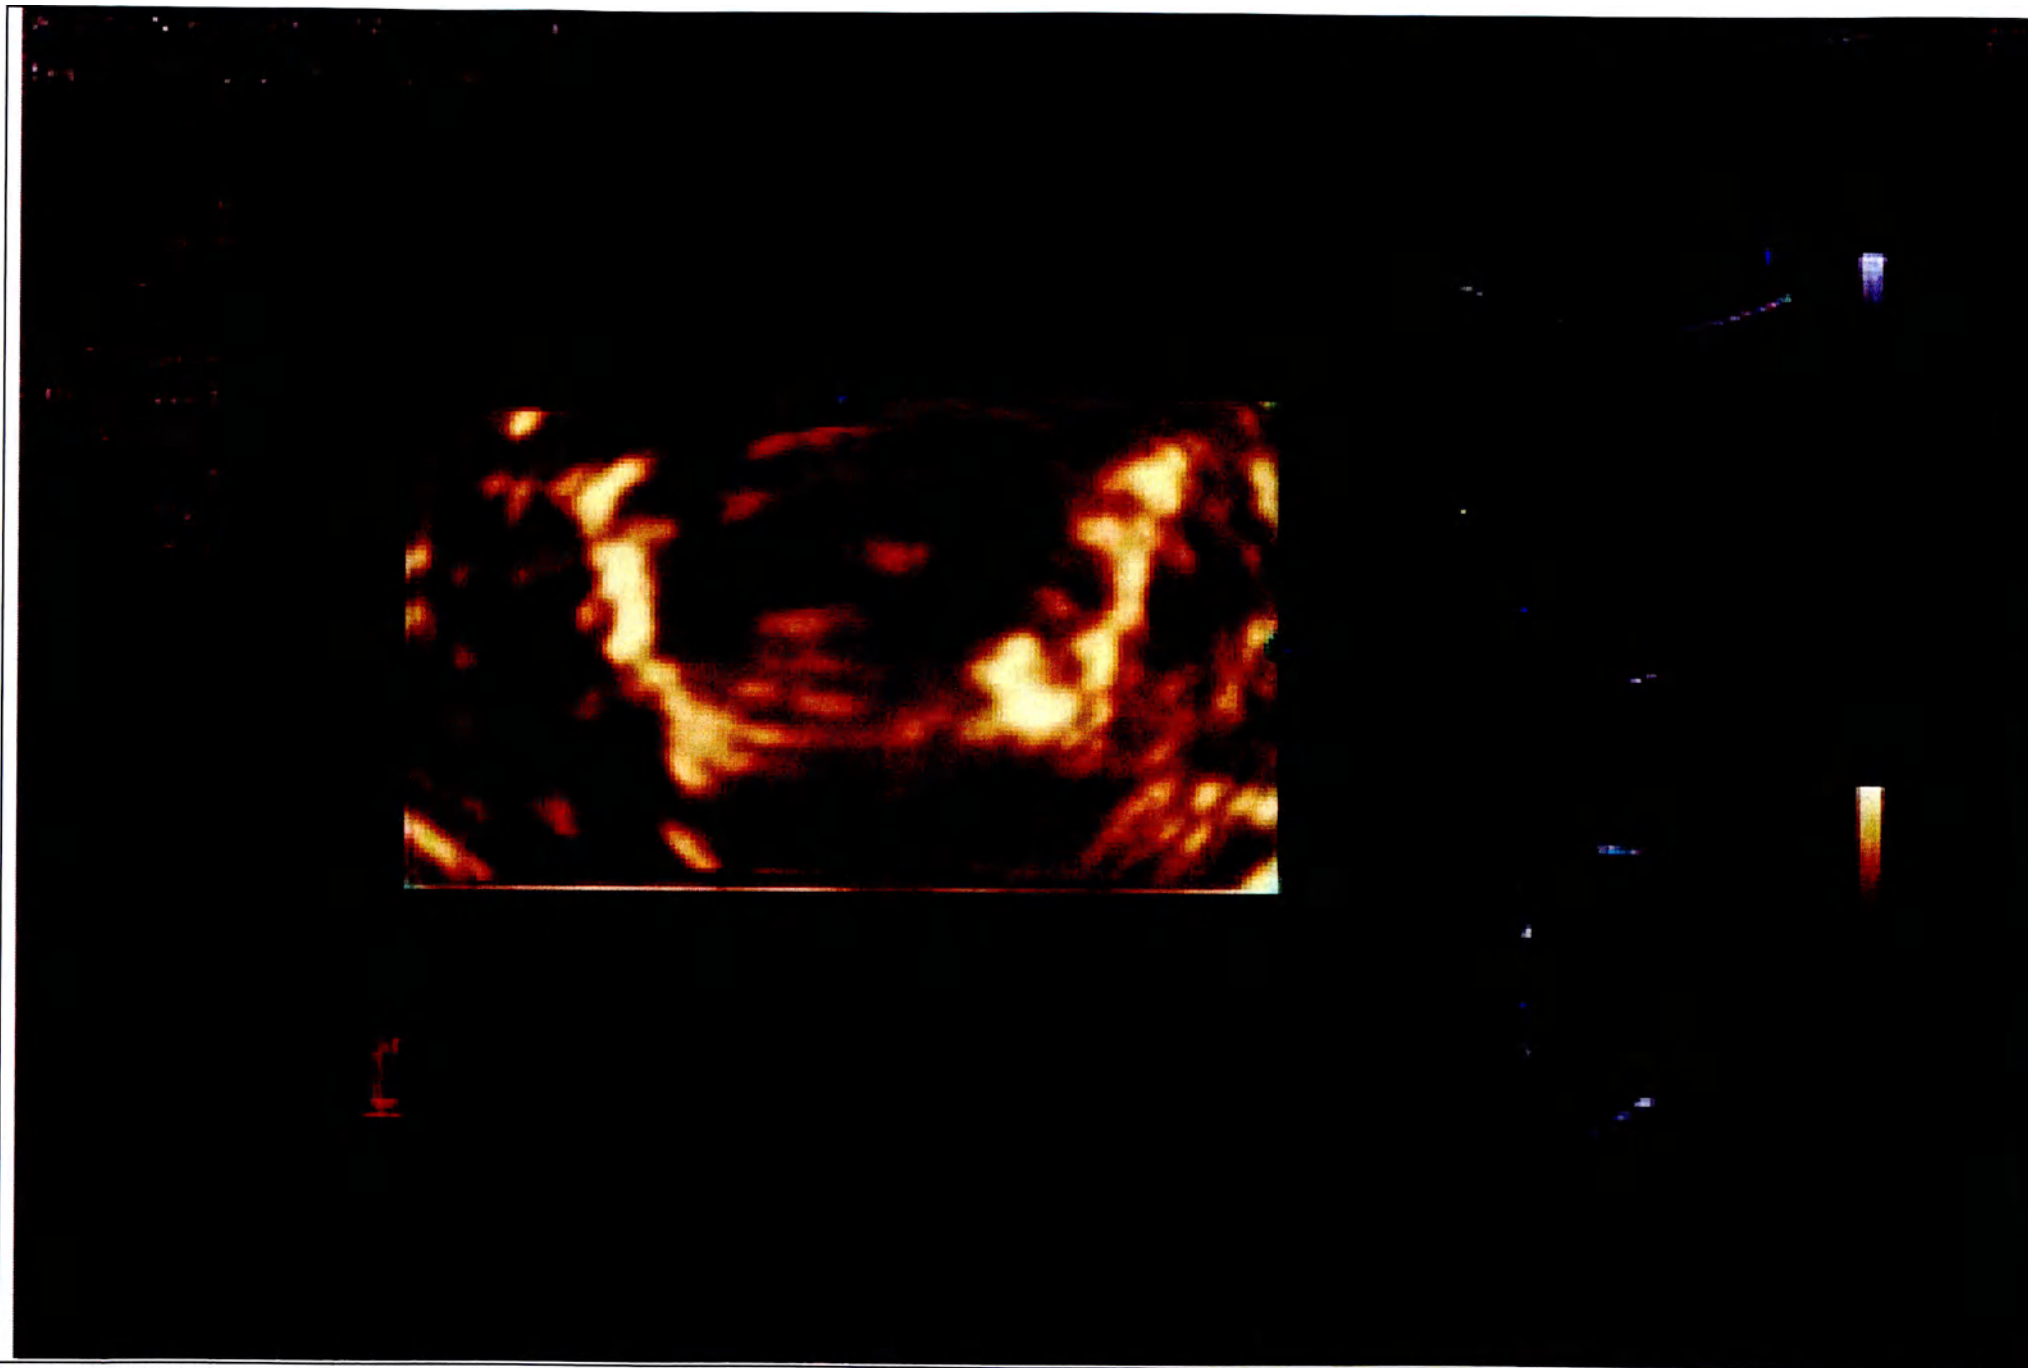


Рисунок 13. Лицензионный ключ для функции трехмерной визуализации (3-Scape) на оптическом и/или электронном носителе.

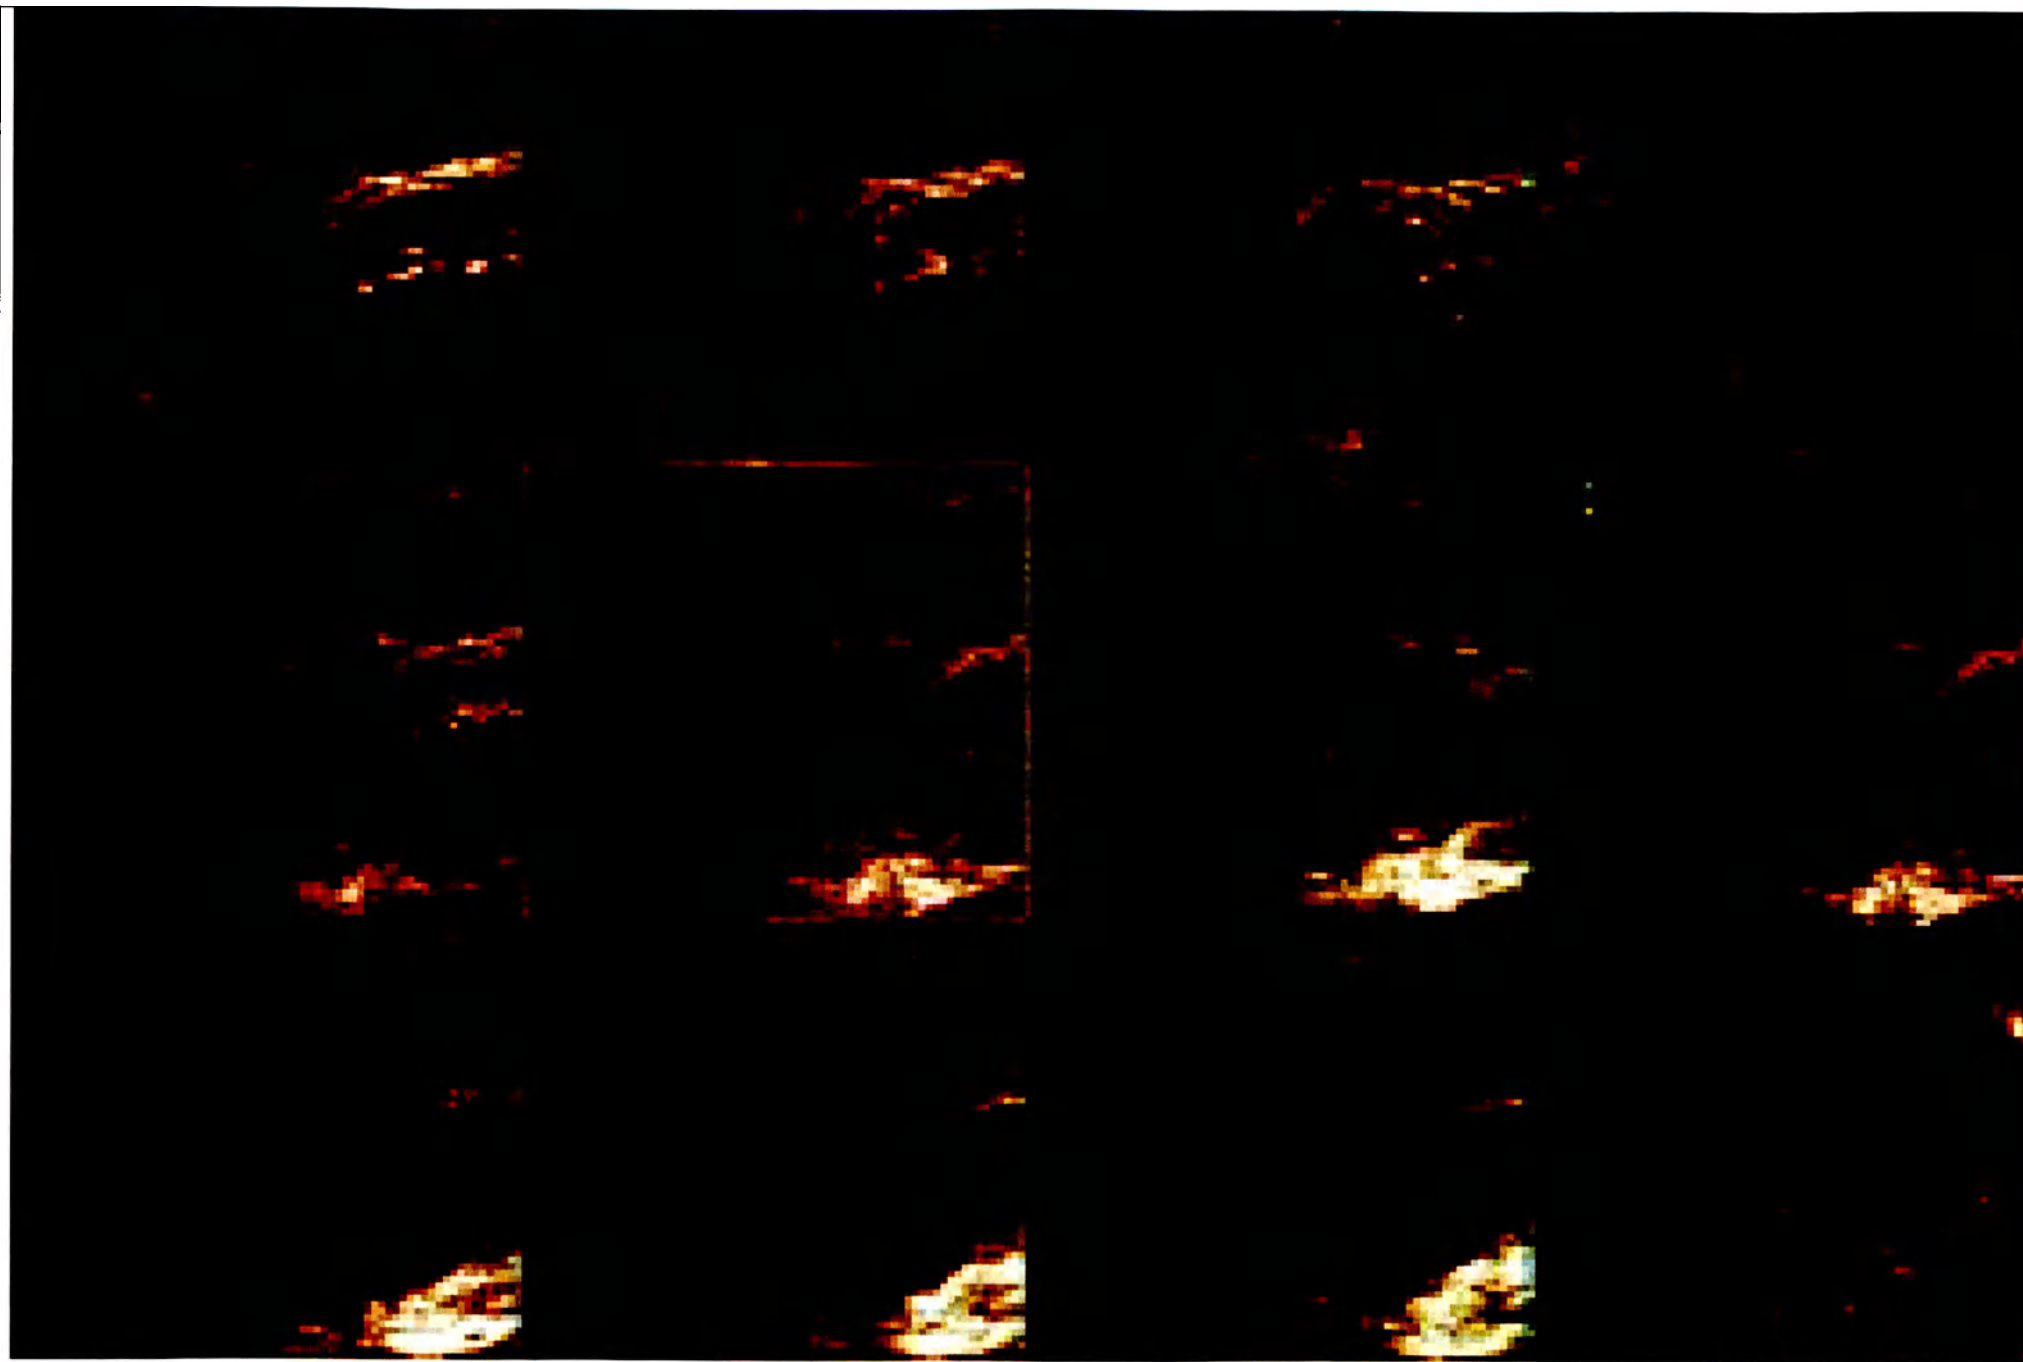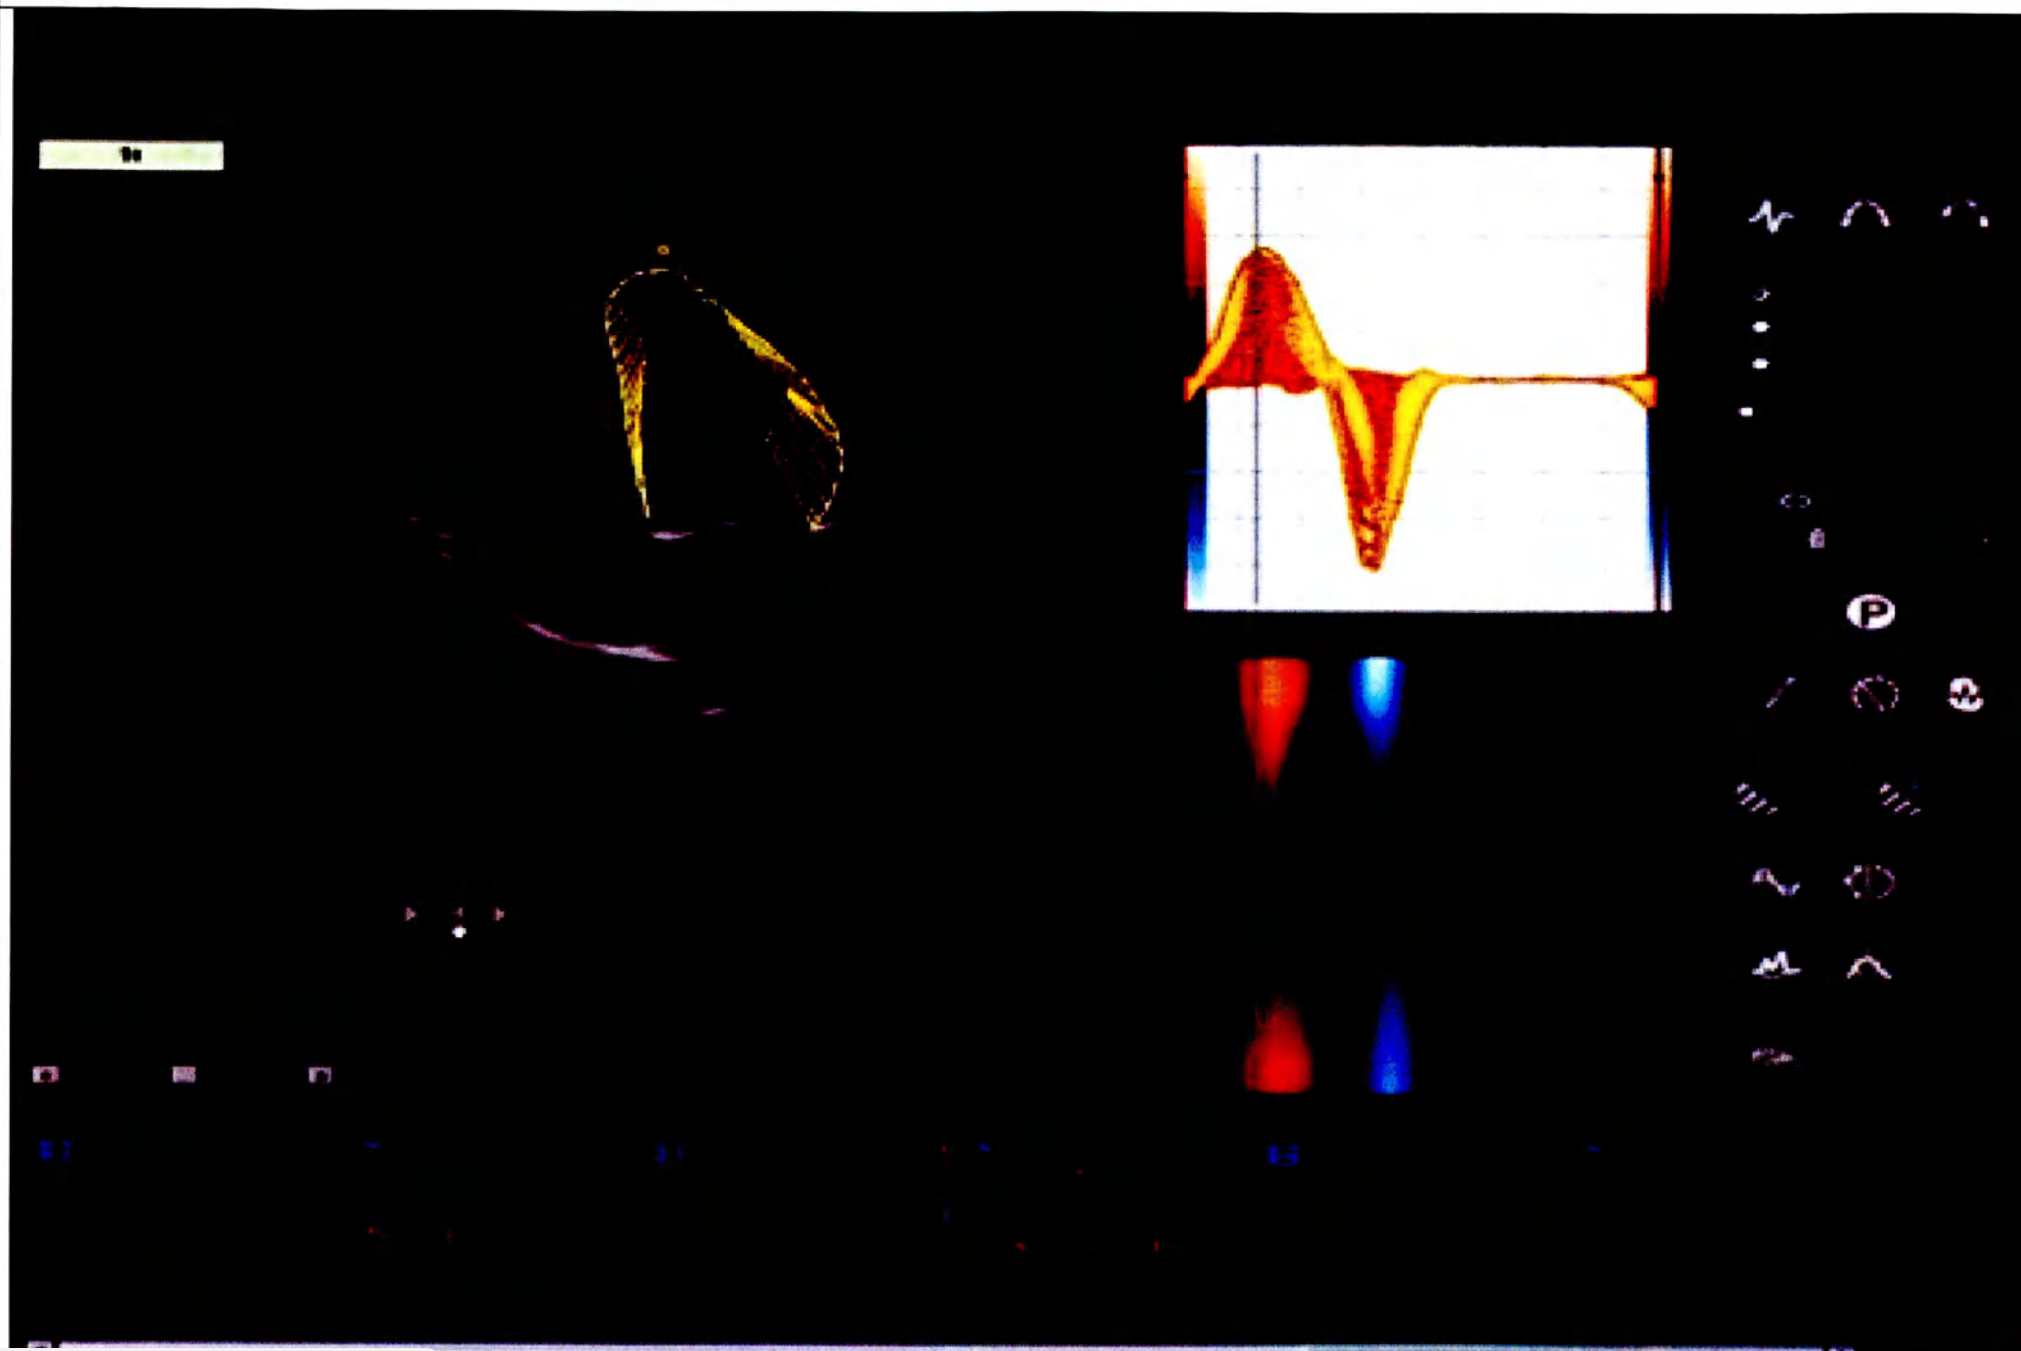

носителе.



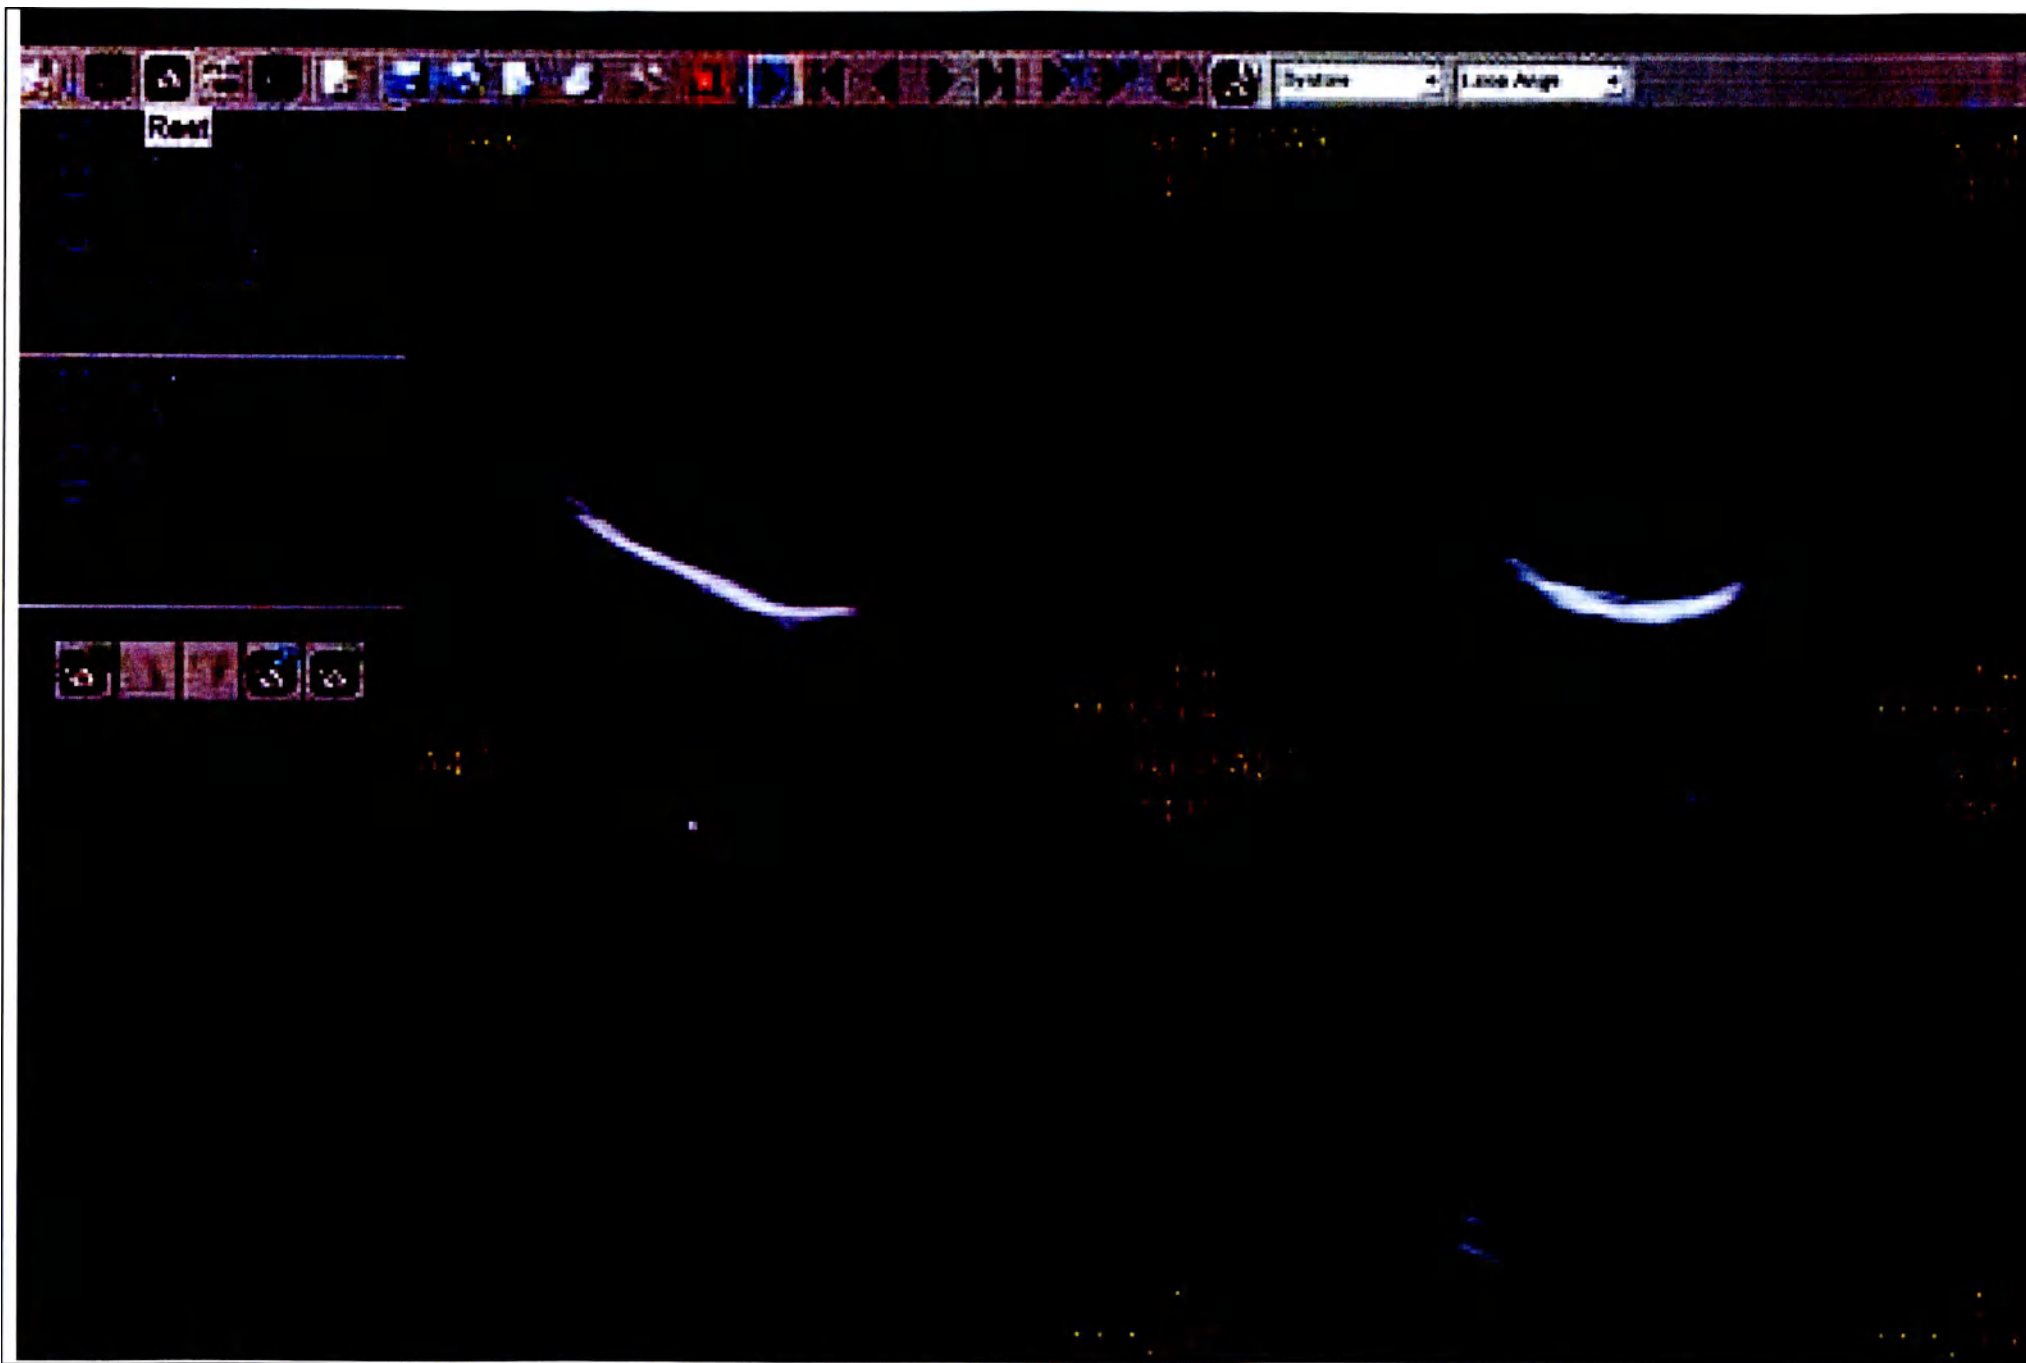


Рисунок 16. Пилецильный криво для функции стресс – эхокардиографии на оптическом и/или электронном носителе.

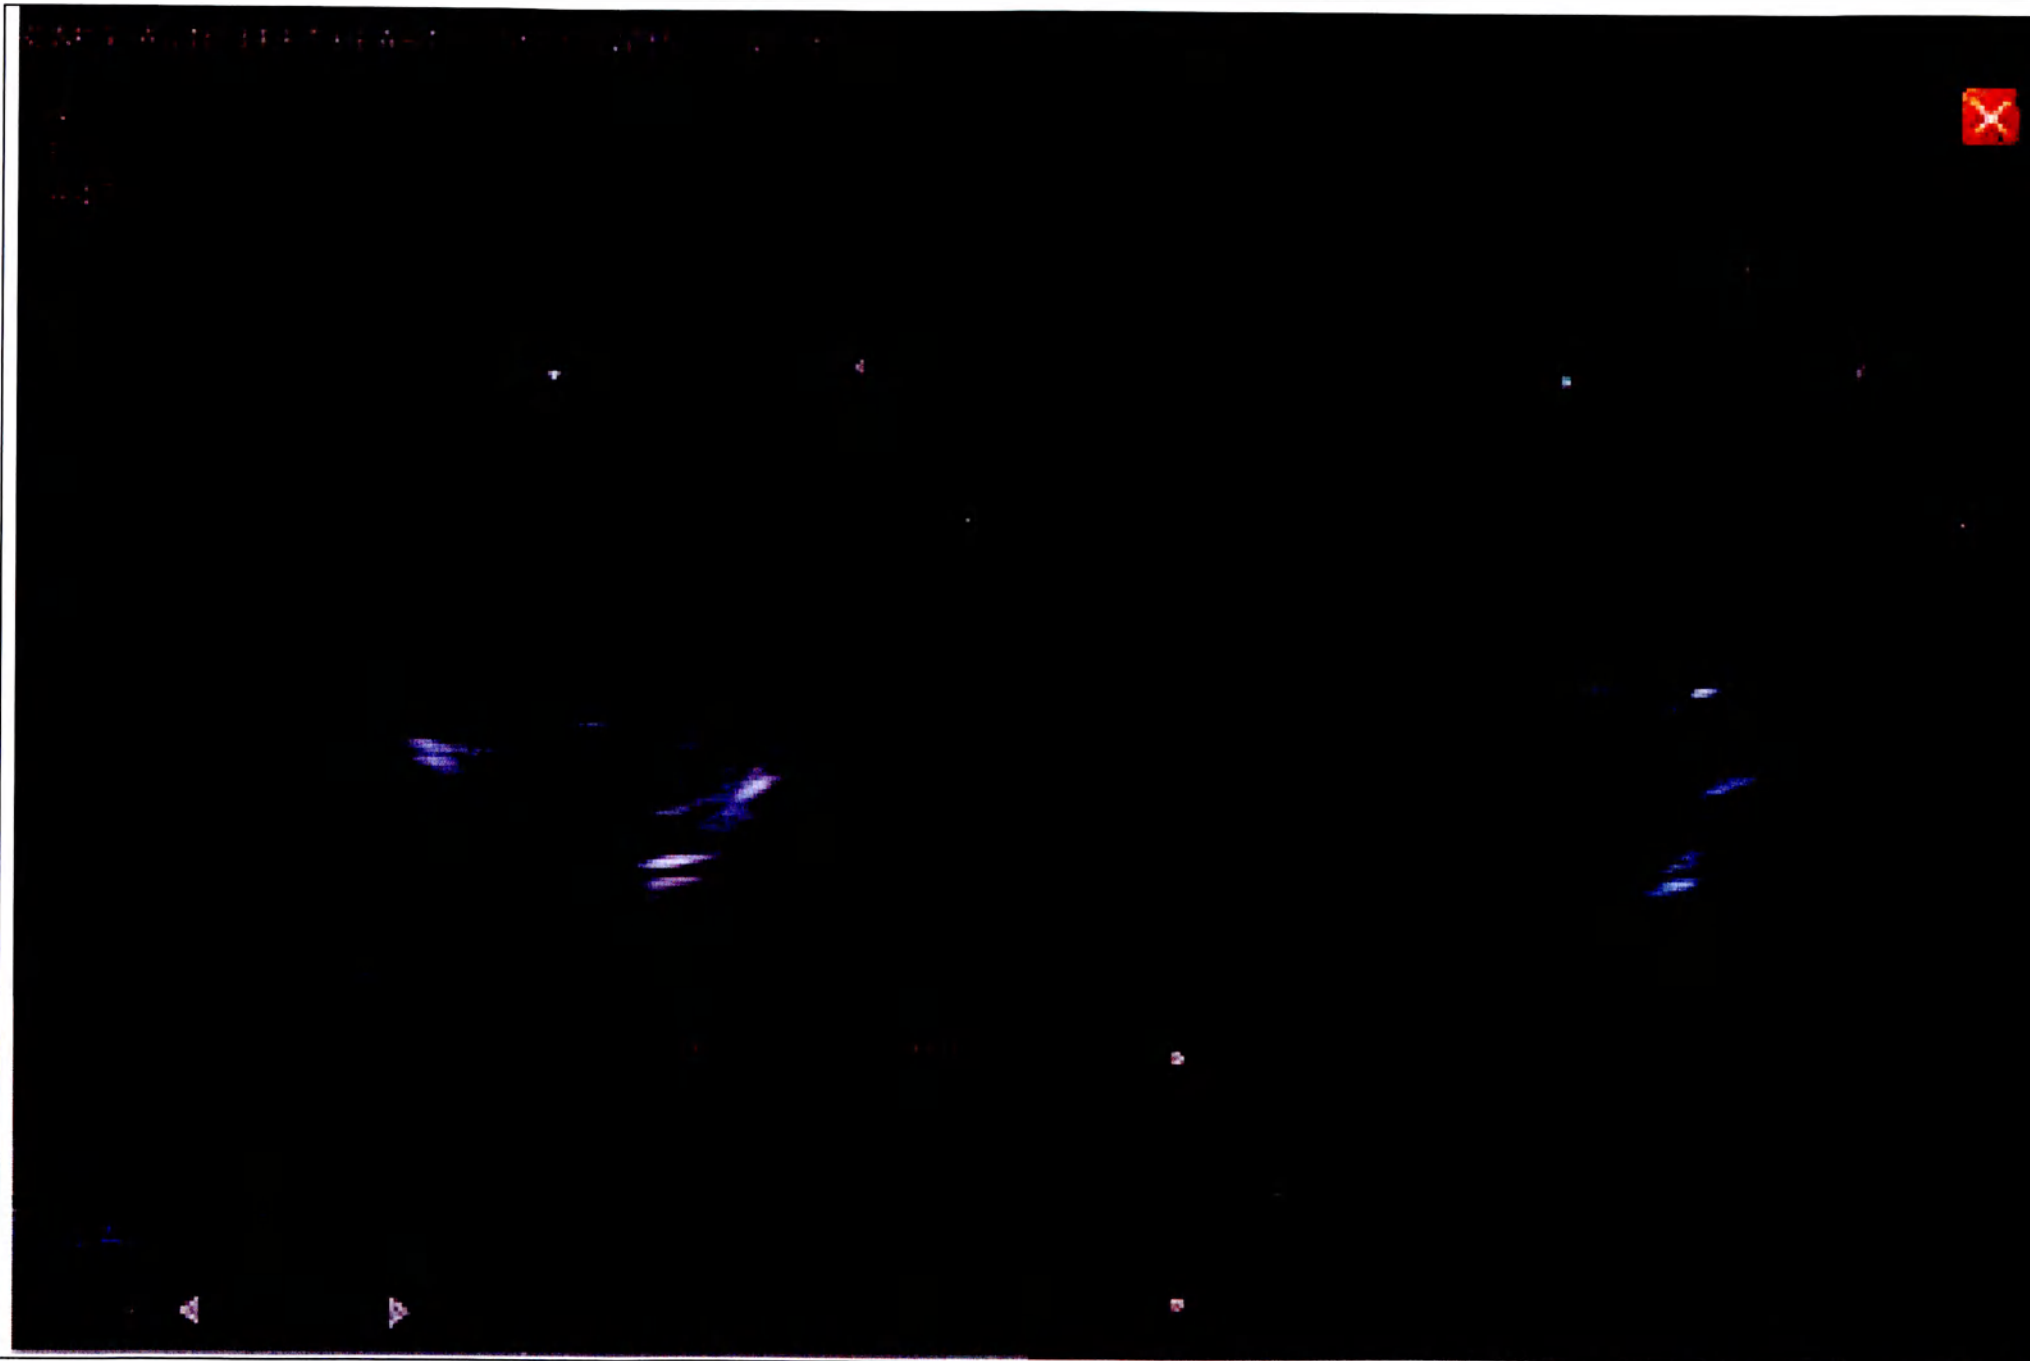


Рисунок 17. Лицензионный ключ для опции автоматического исследования левых отделов сердца (syngo Auto Left Heart) на оптическом и/или электронном

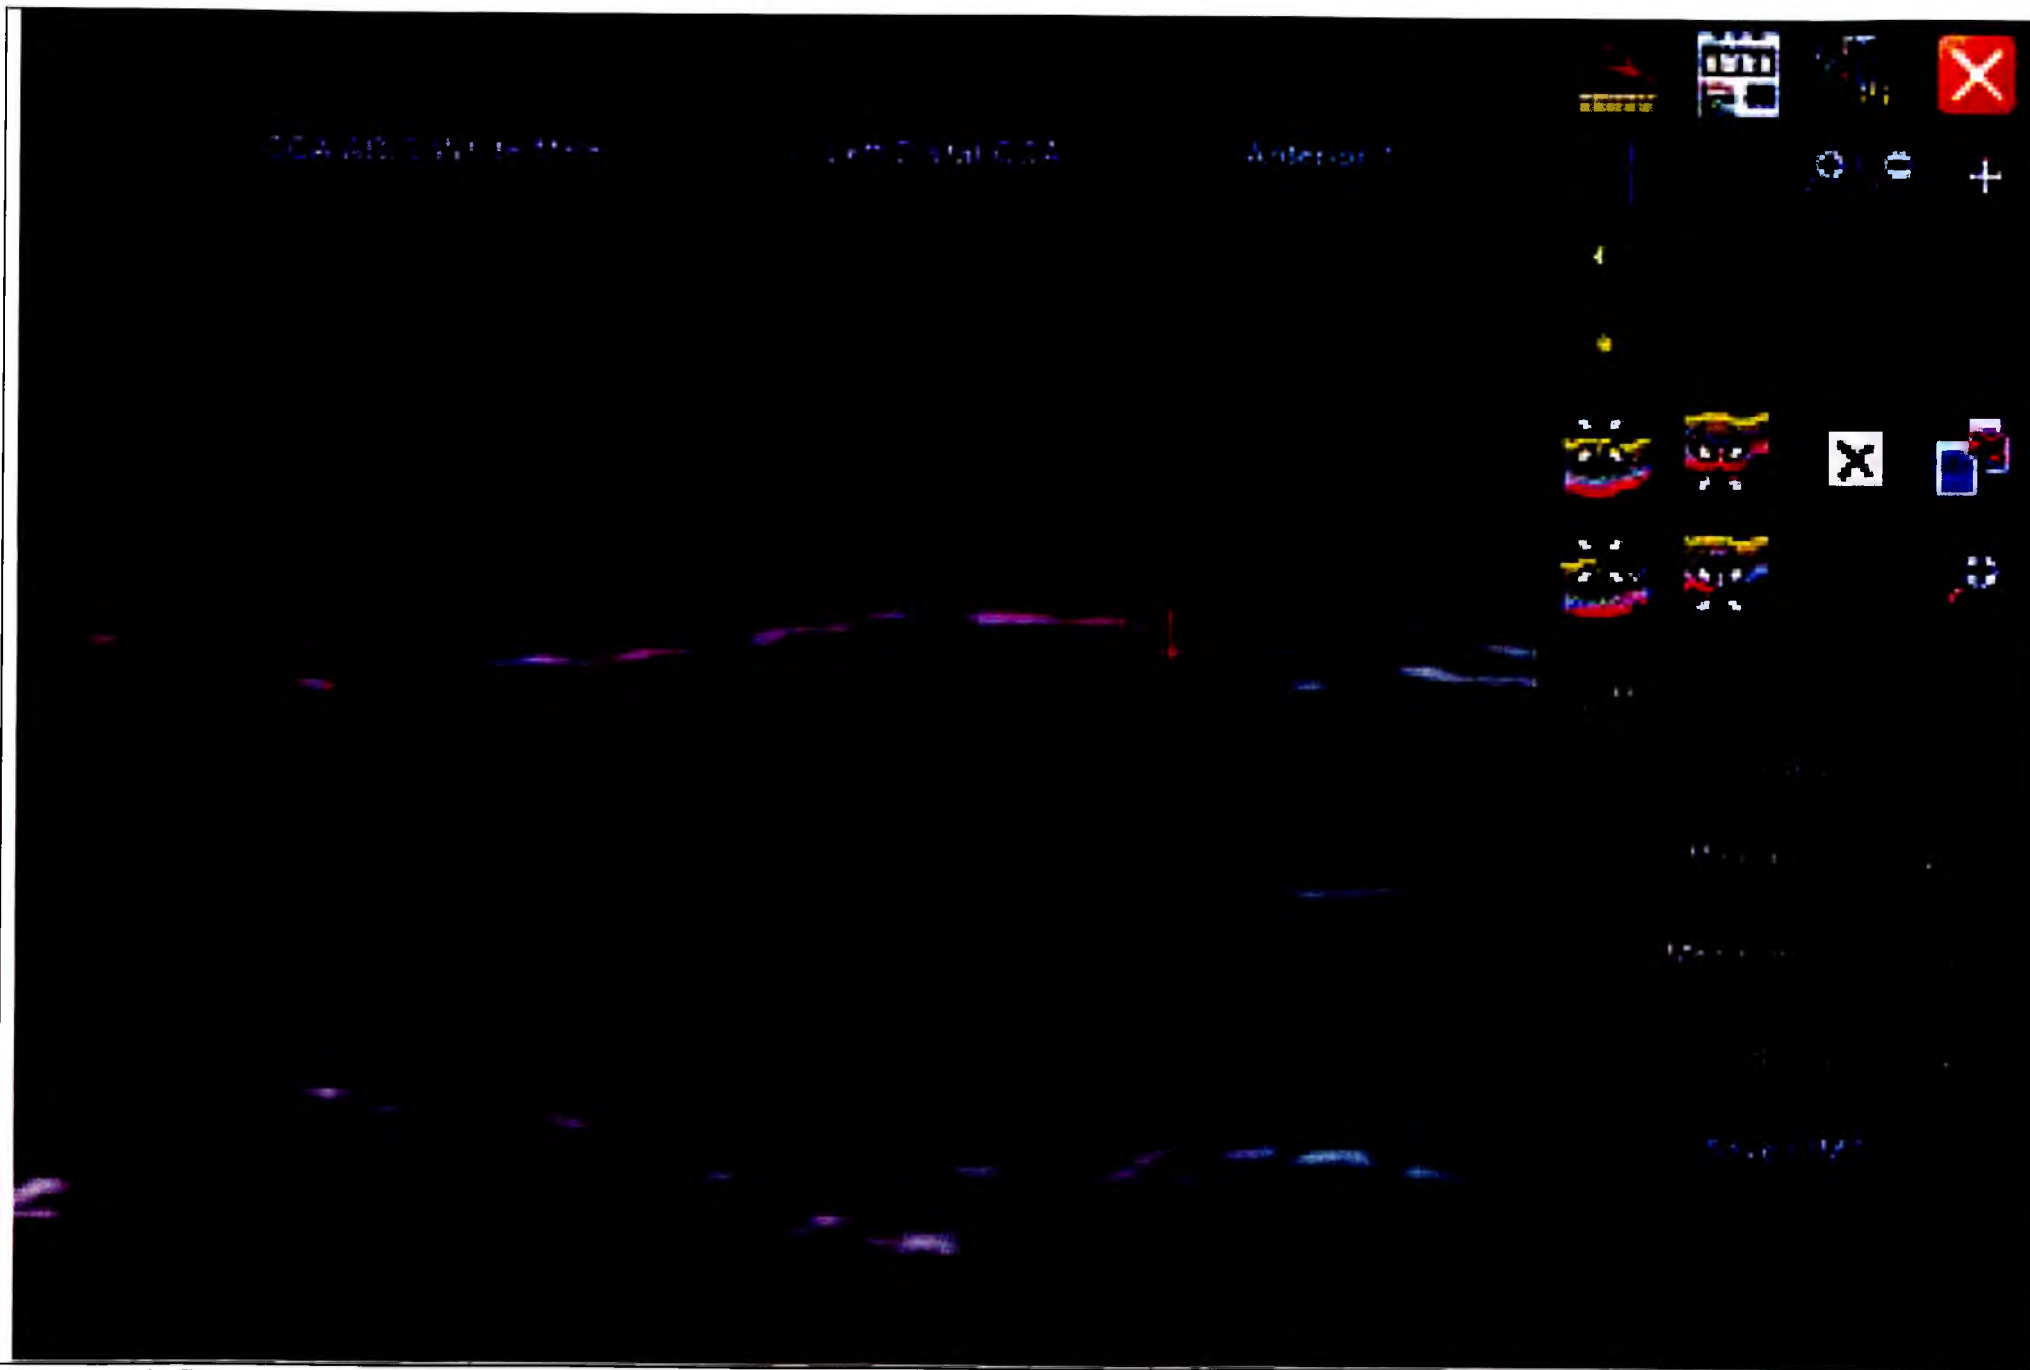


Рисунок 18. Лицензионный ключ для программного обеспечения полуавтоматического обнаружения границ и количественного анализа толщины интима -
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 Медиа сосуда артерий **Arterial Health Package (AHP)** на оптическом и/или электронном носителе.

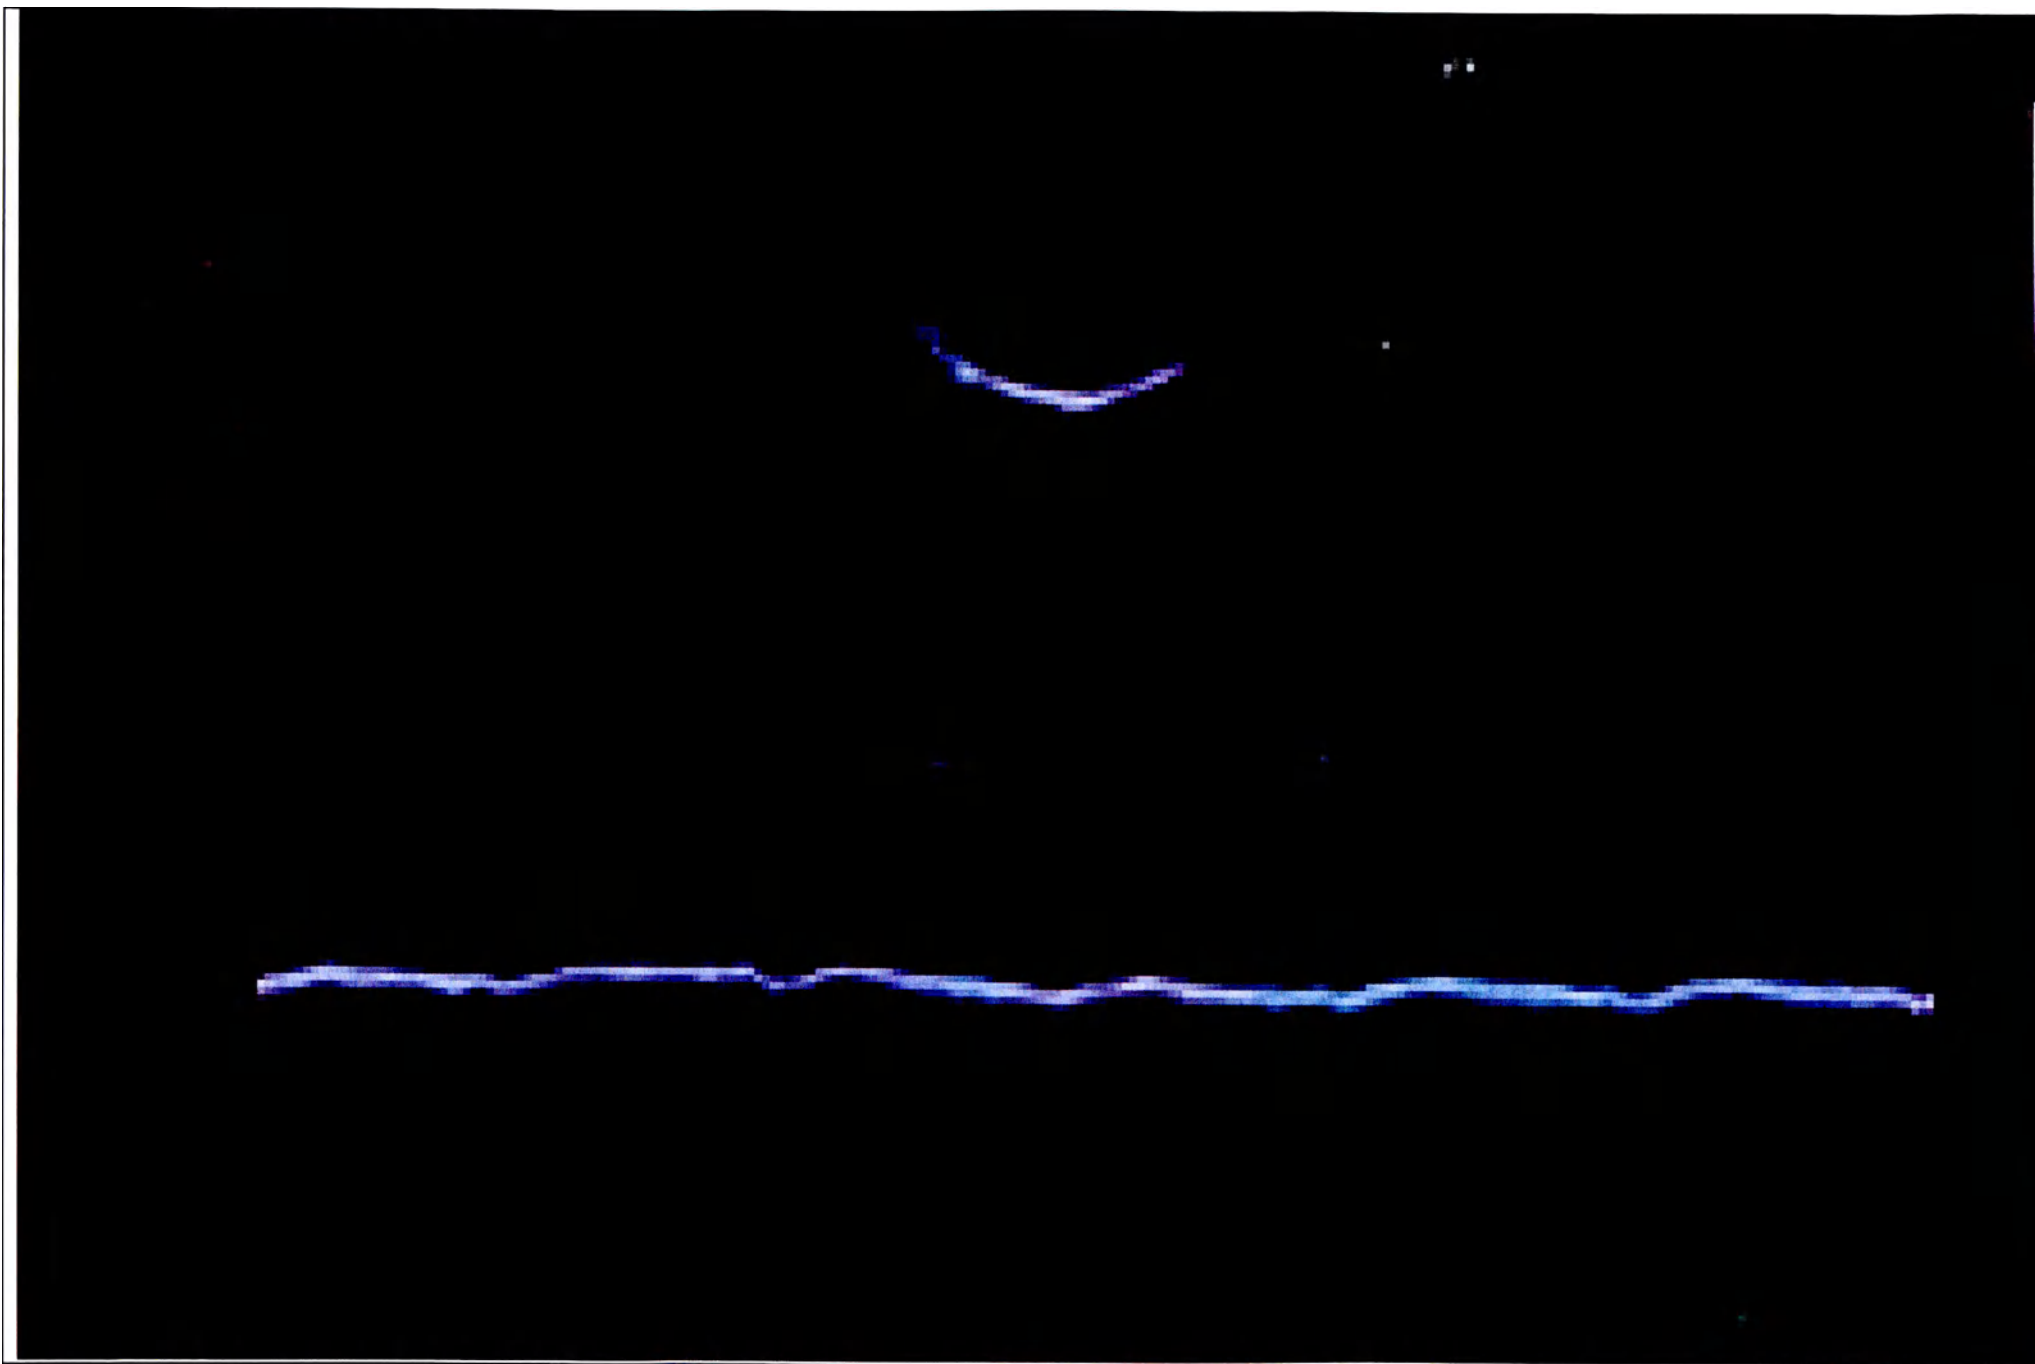


Рисунок 19. Пилециальный кривой для функции анатомического М-режима (АММ) на оптическом и/или электронном носителе.

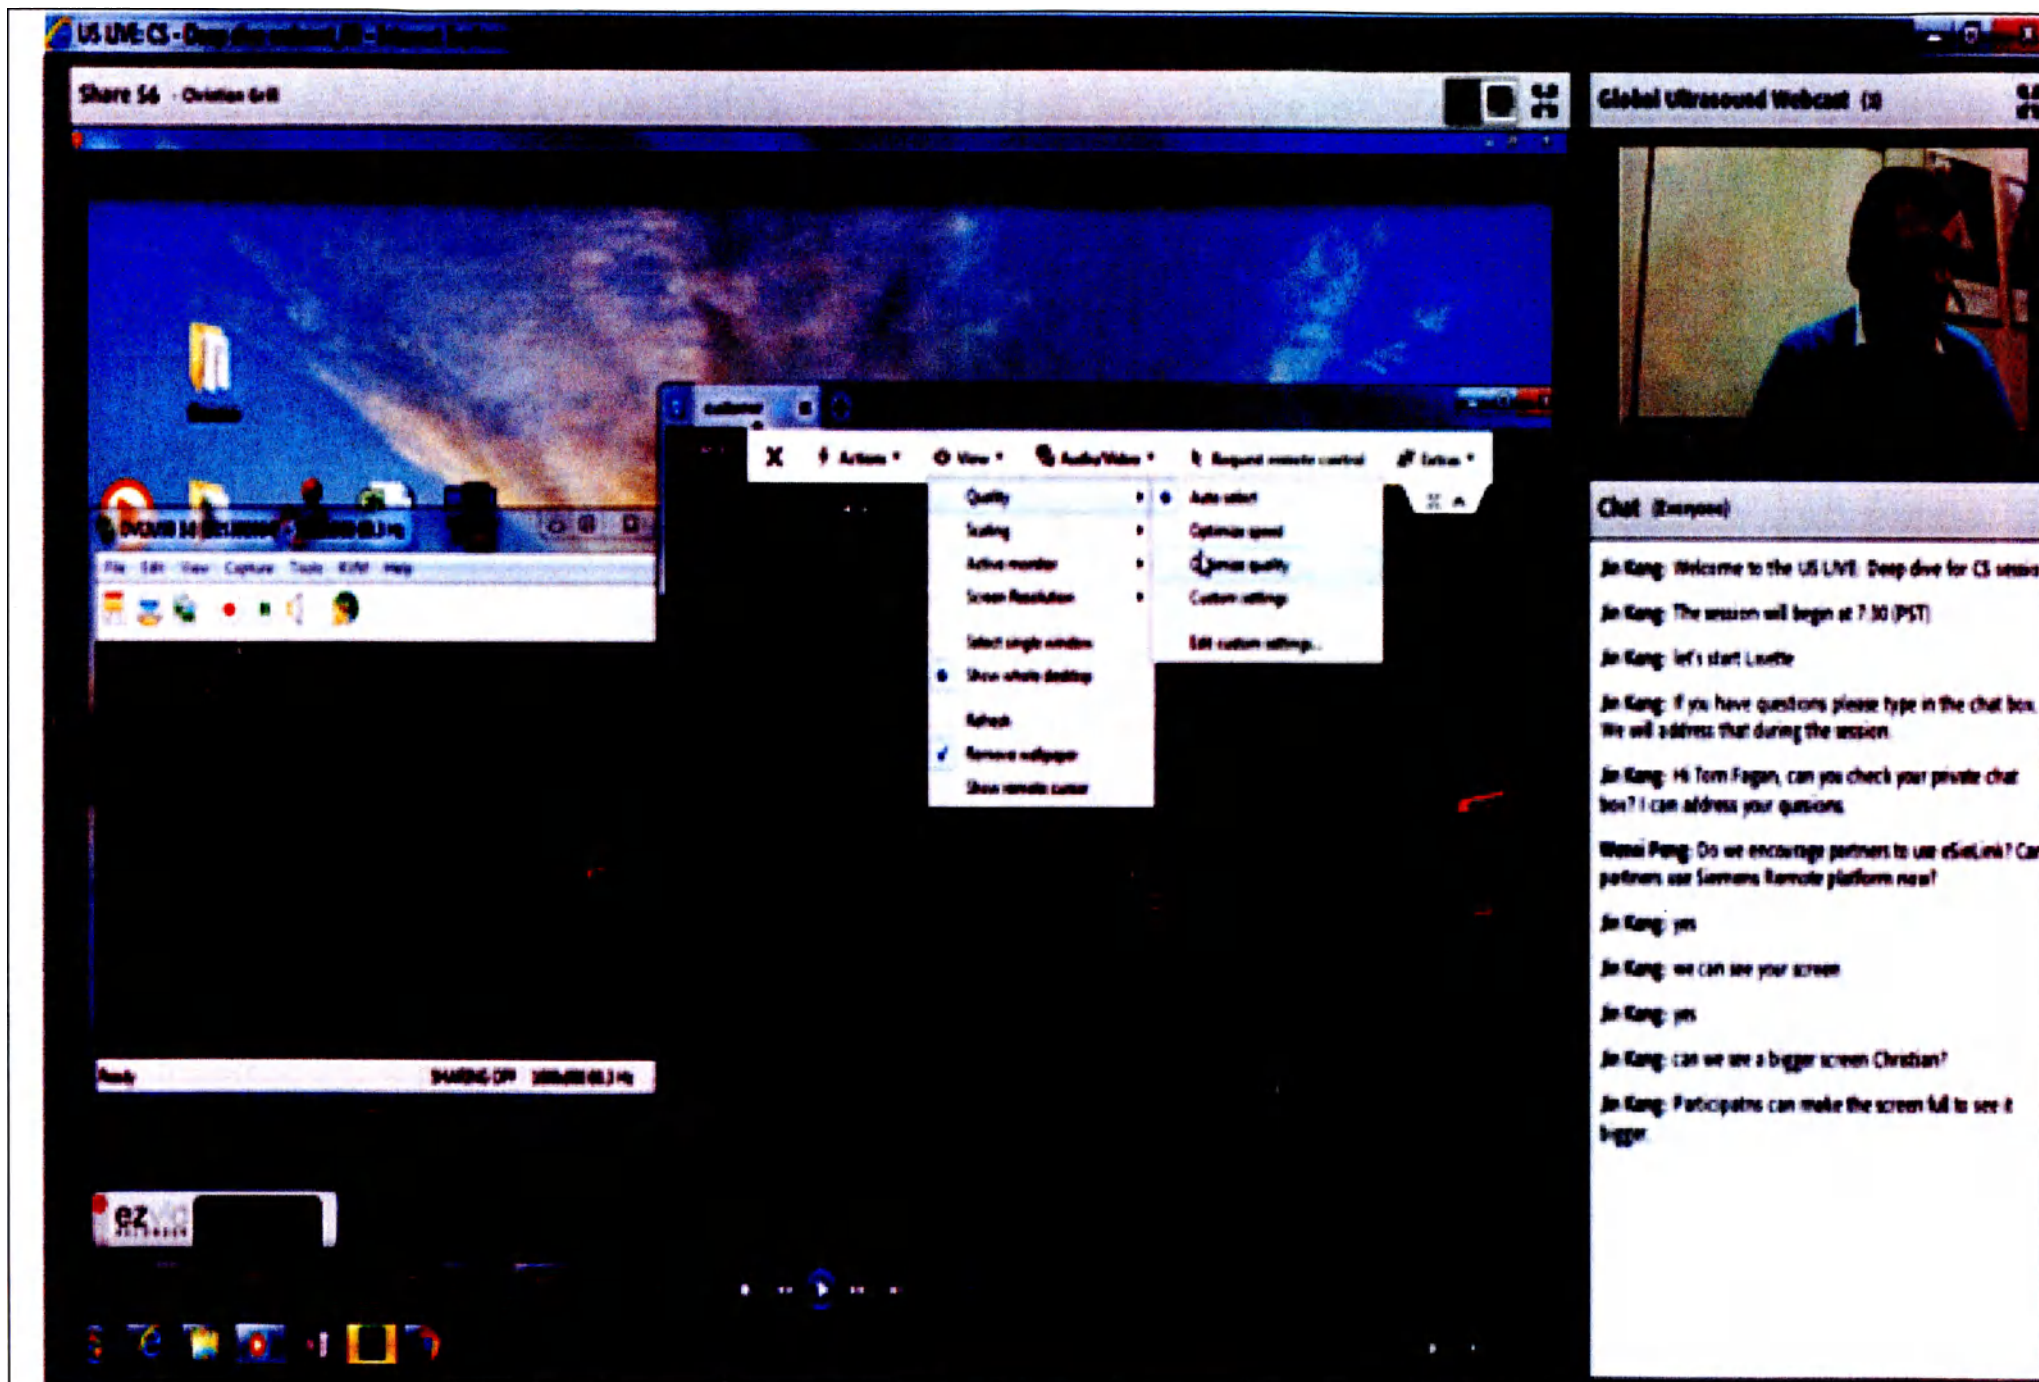


Рисунок 21. Лицензионный ключ для технологии тканевой доплерографии (DTI) на оптическом и/или электронном носителе.

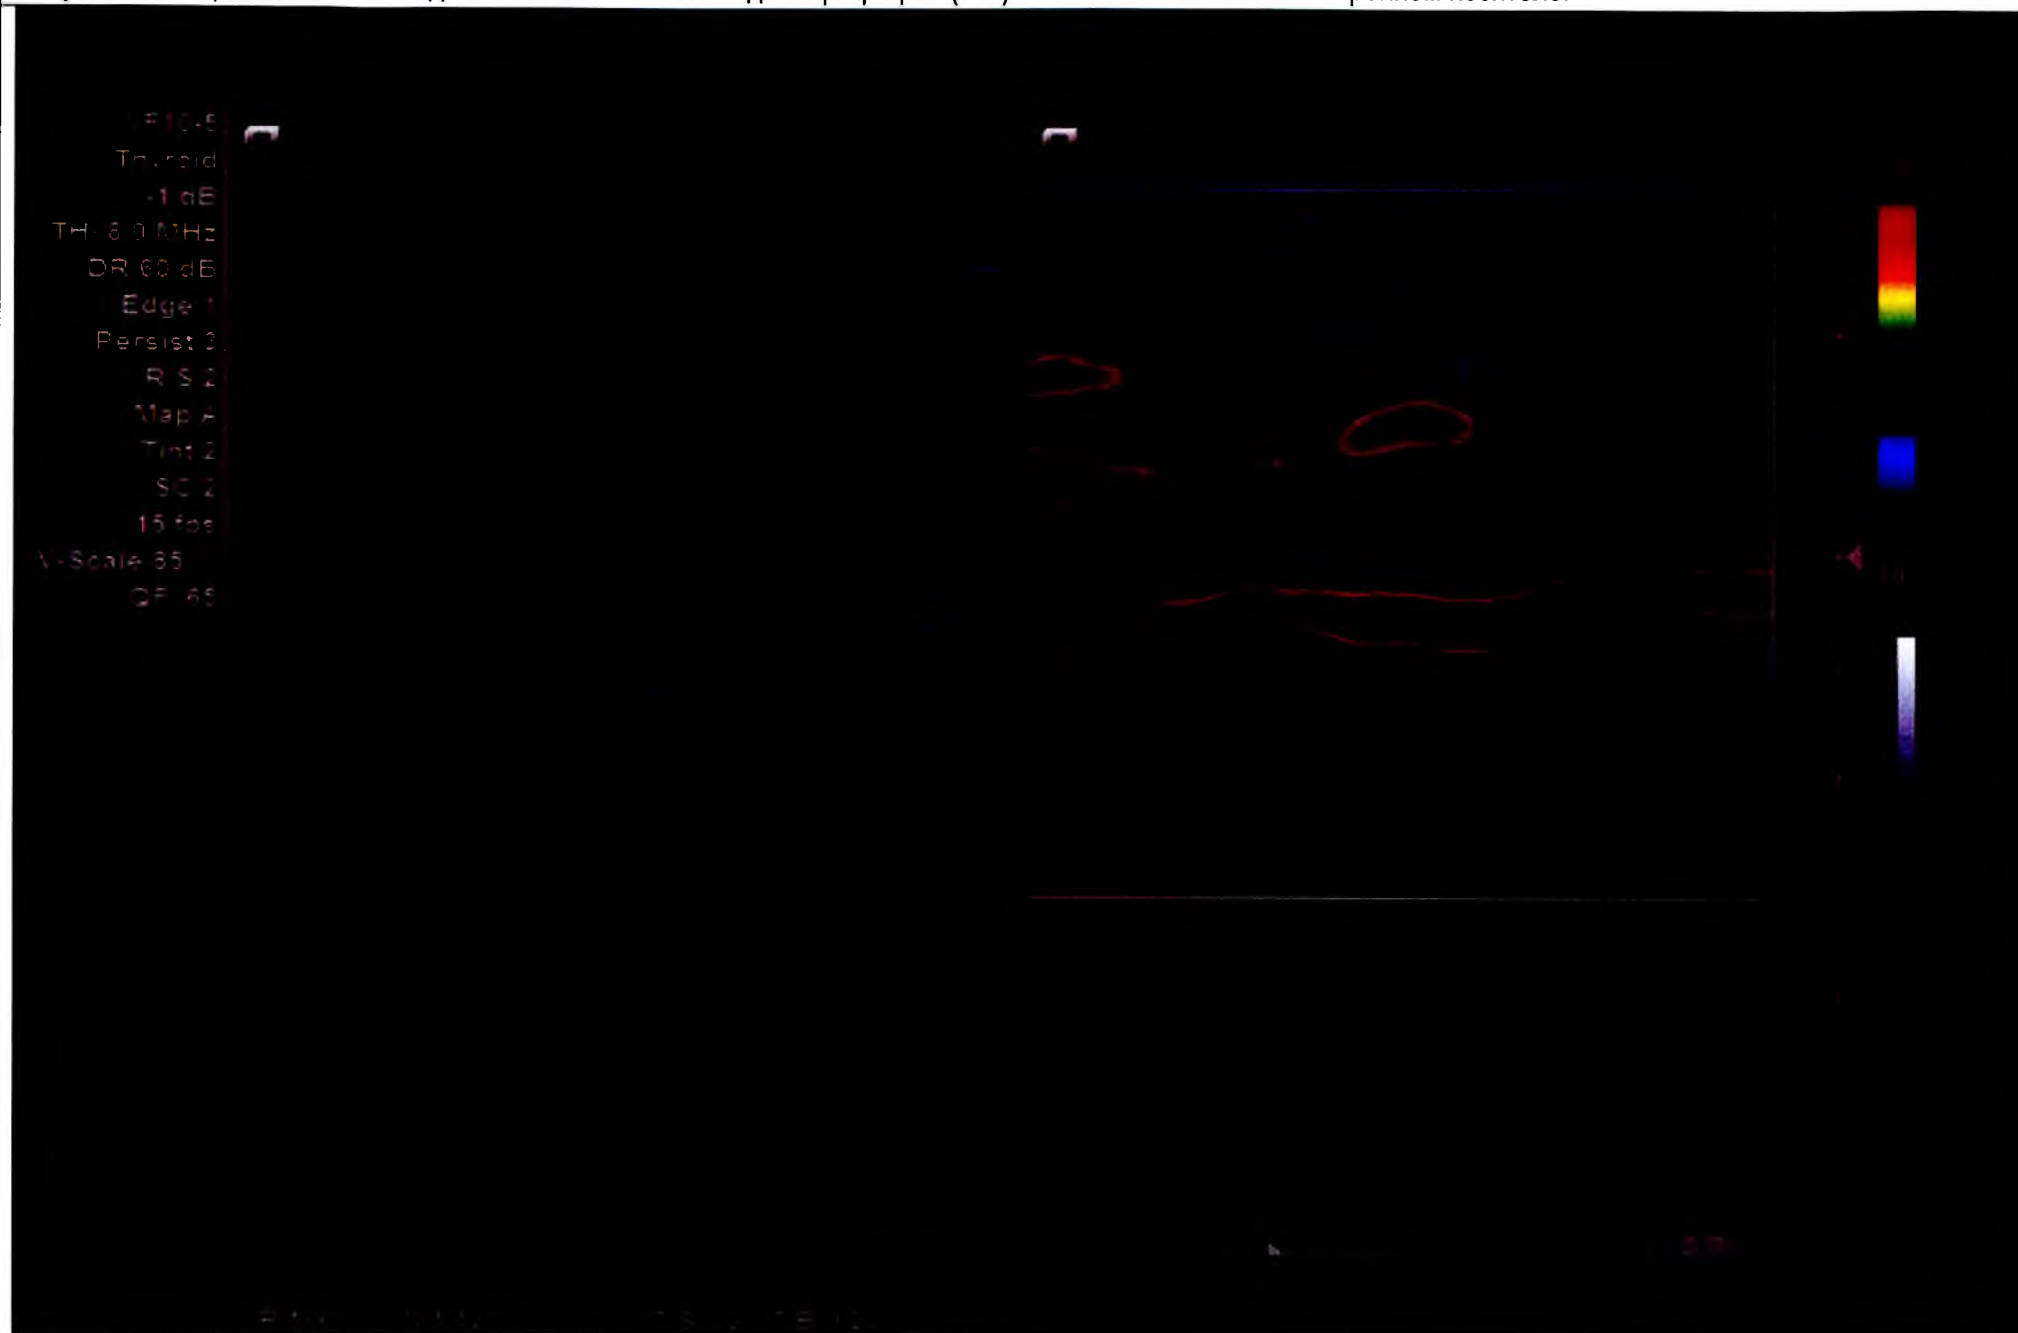


Рисунок 22. Лицензионный ключ для визуализации эластичности ткани (eSie Touch) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 23. Адаптер иглопроводника к датчику CH5-2

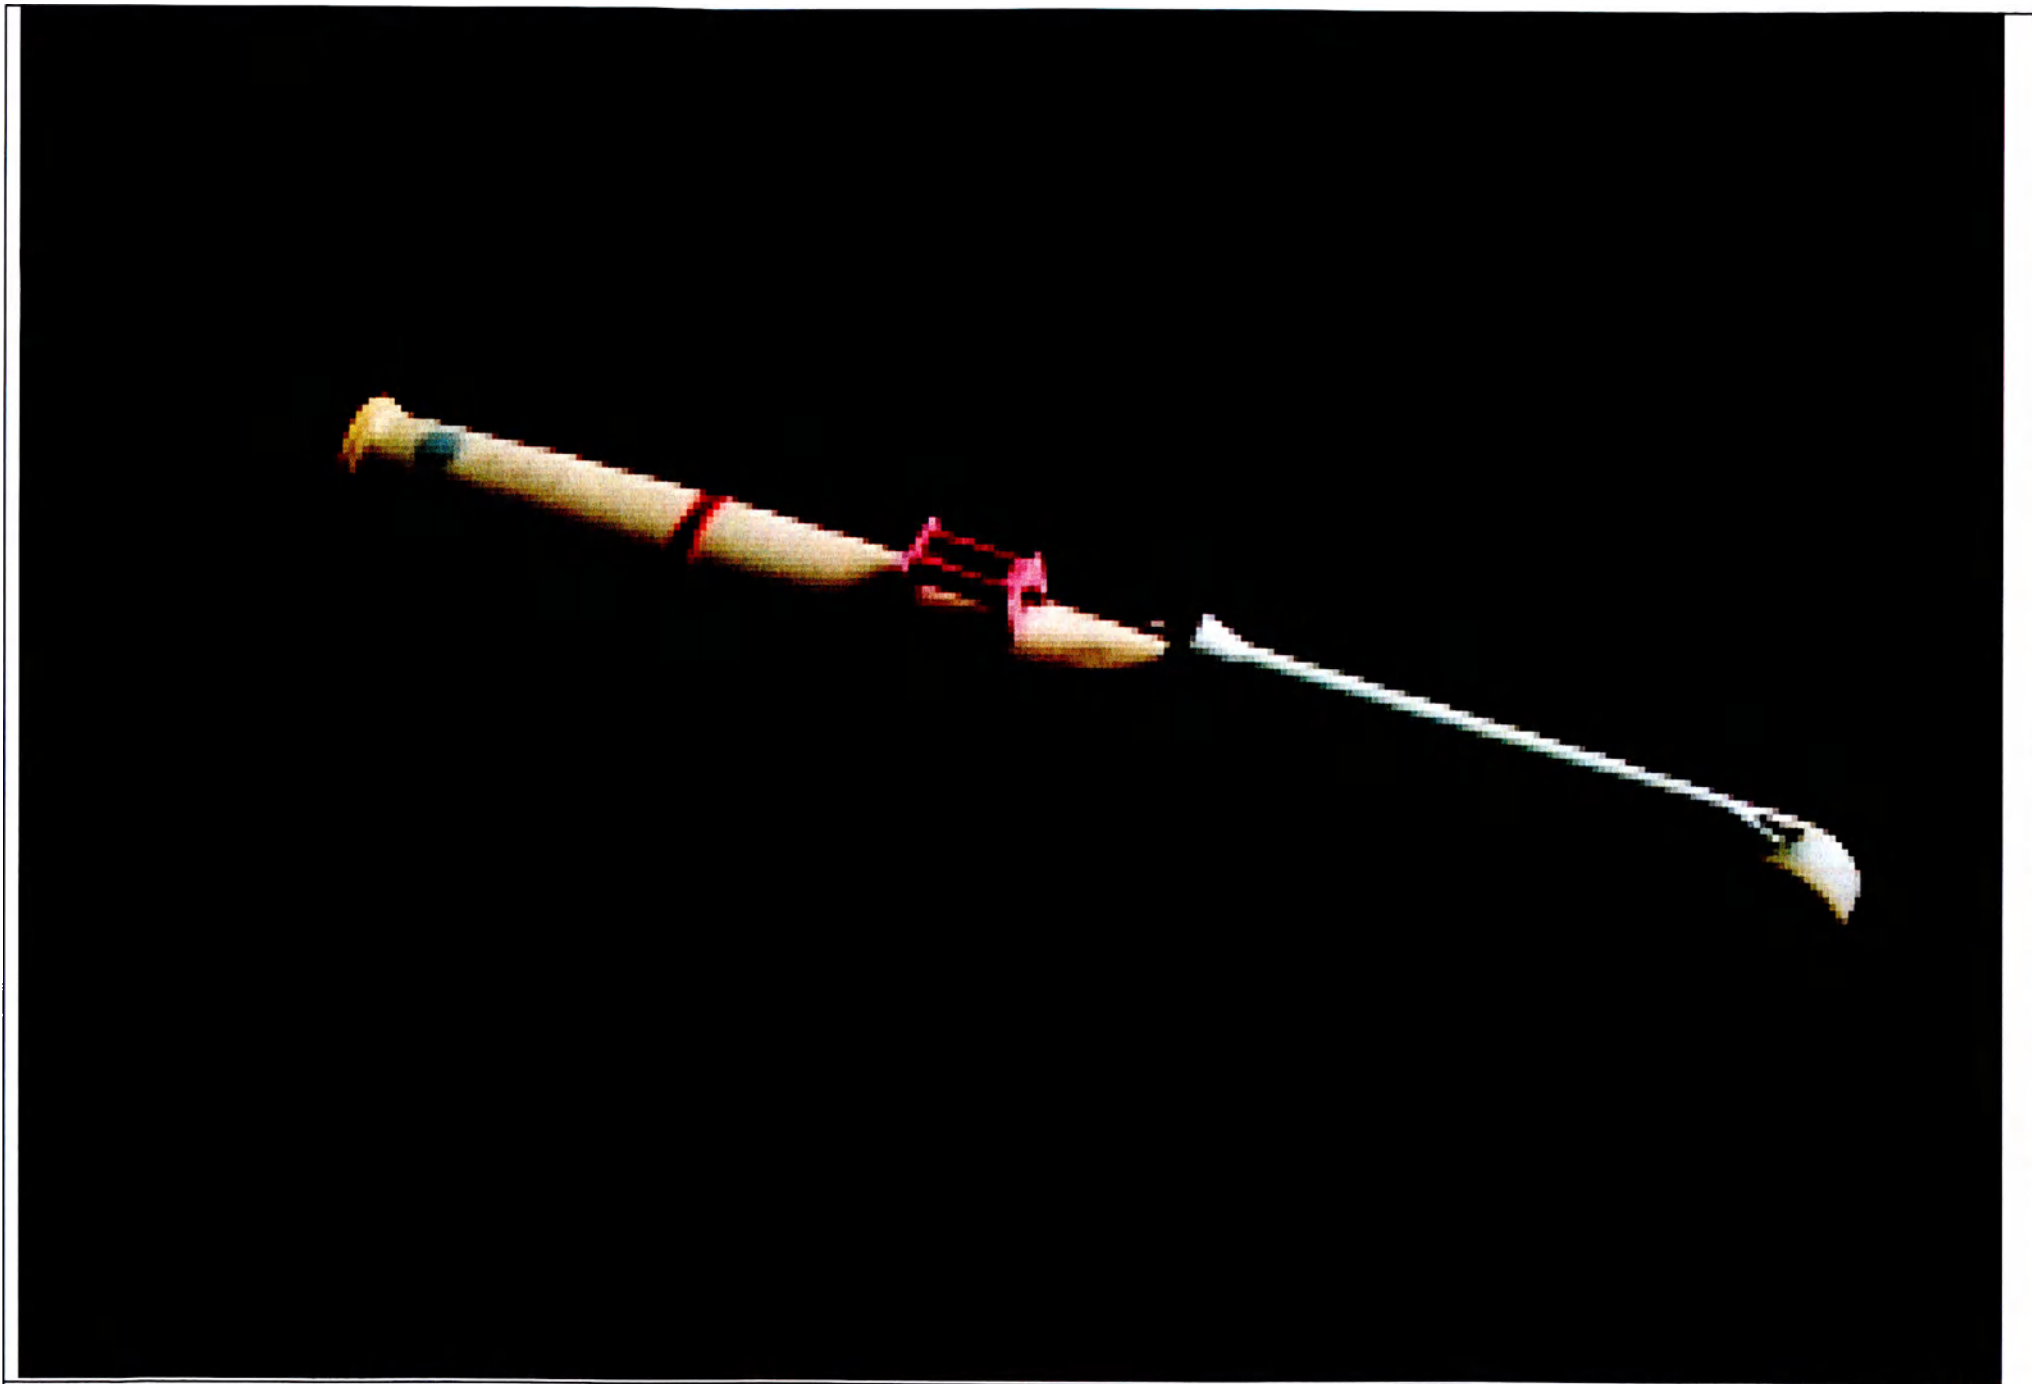


Рисунок 24. Адаптер иглопроводника к датчику C5-2v















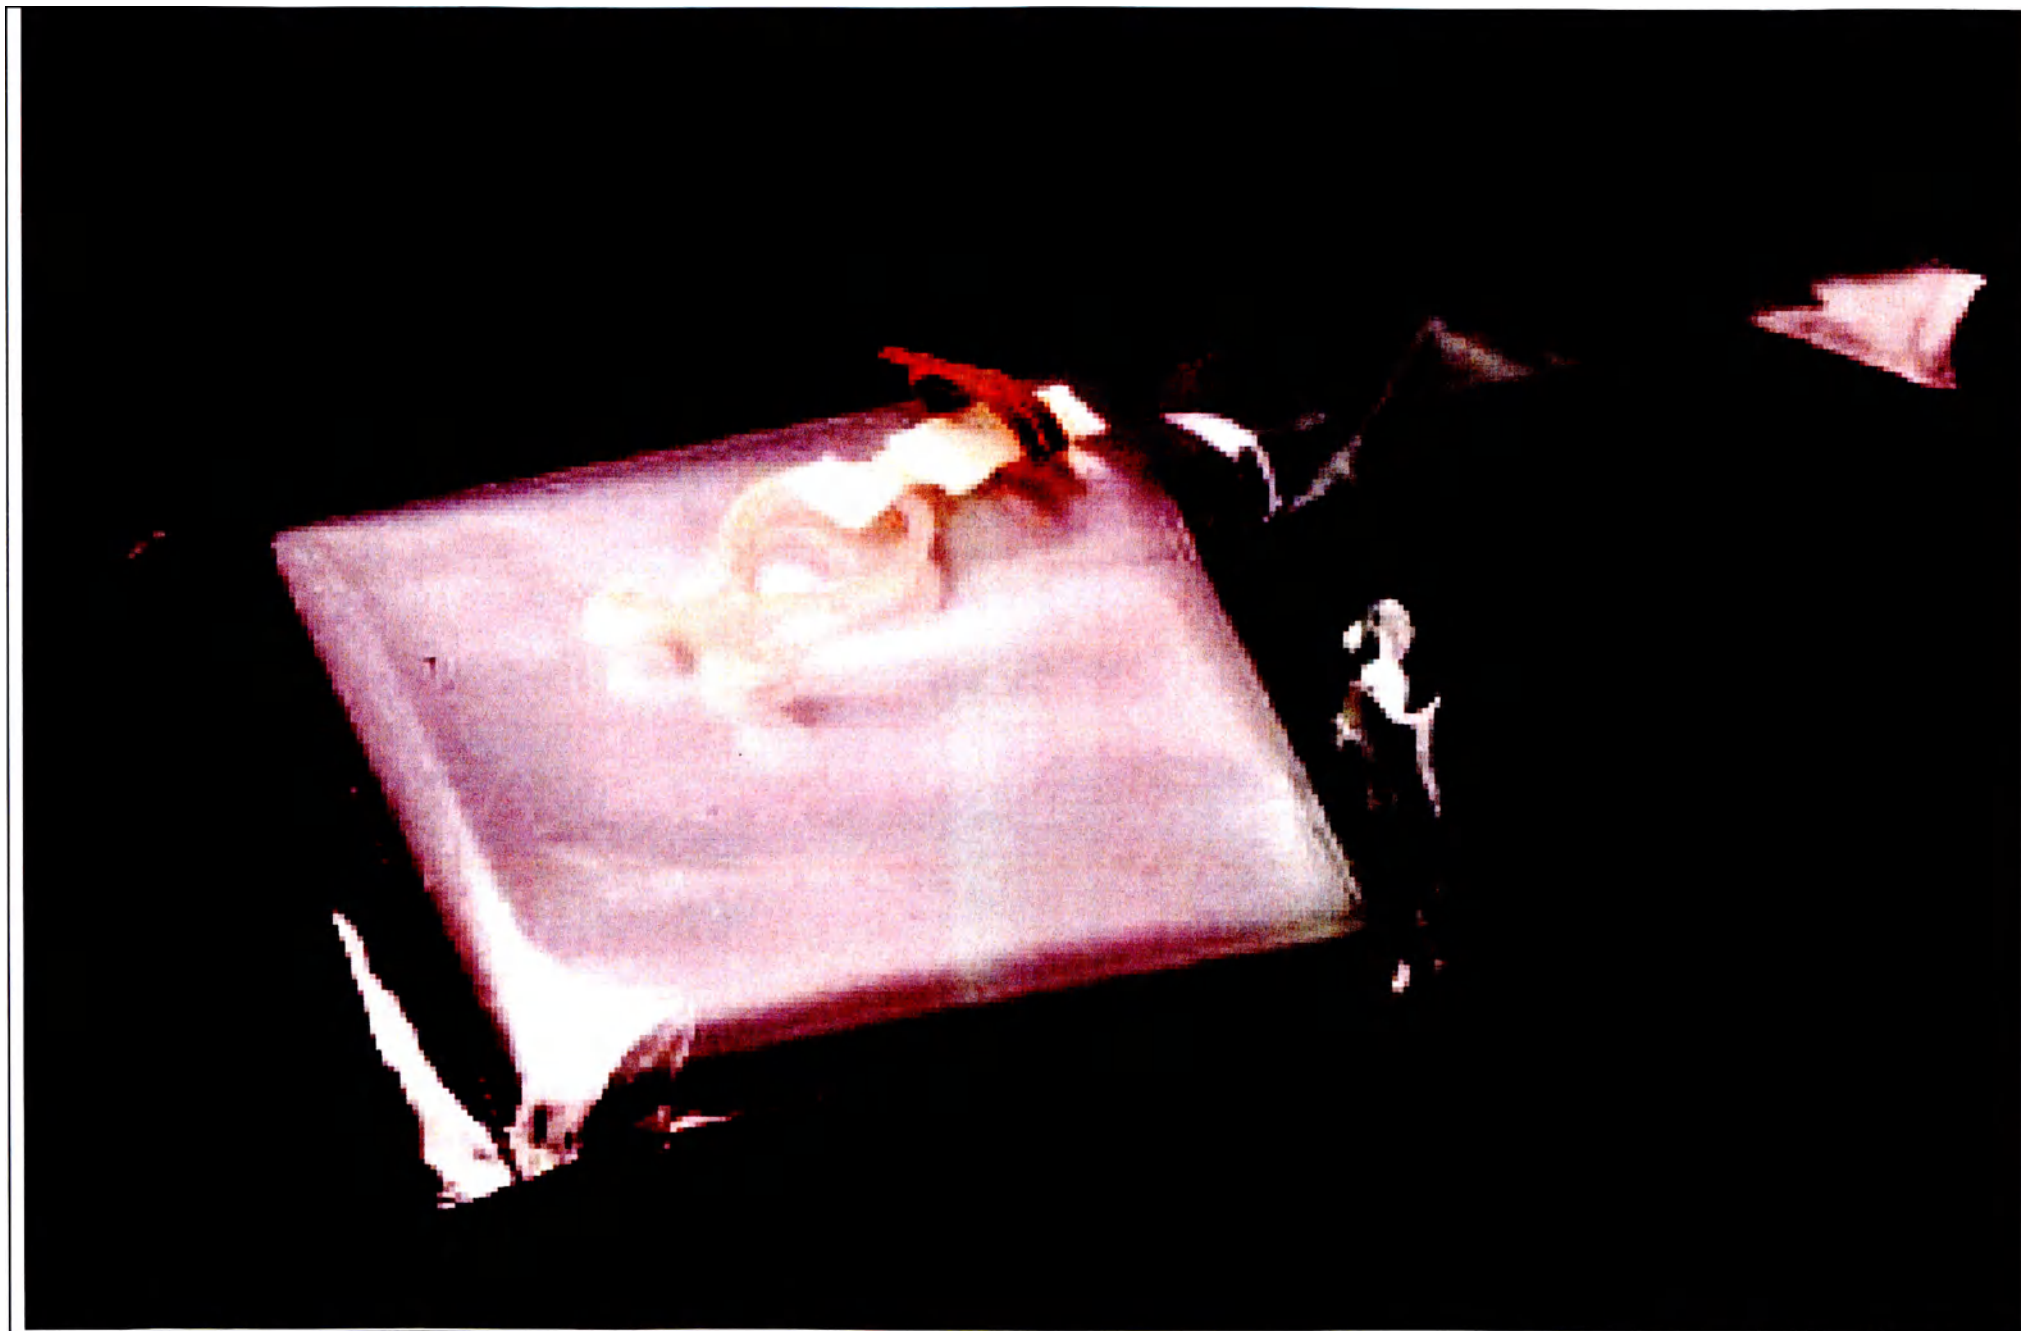
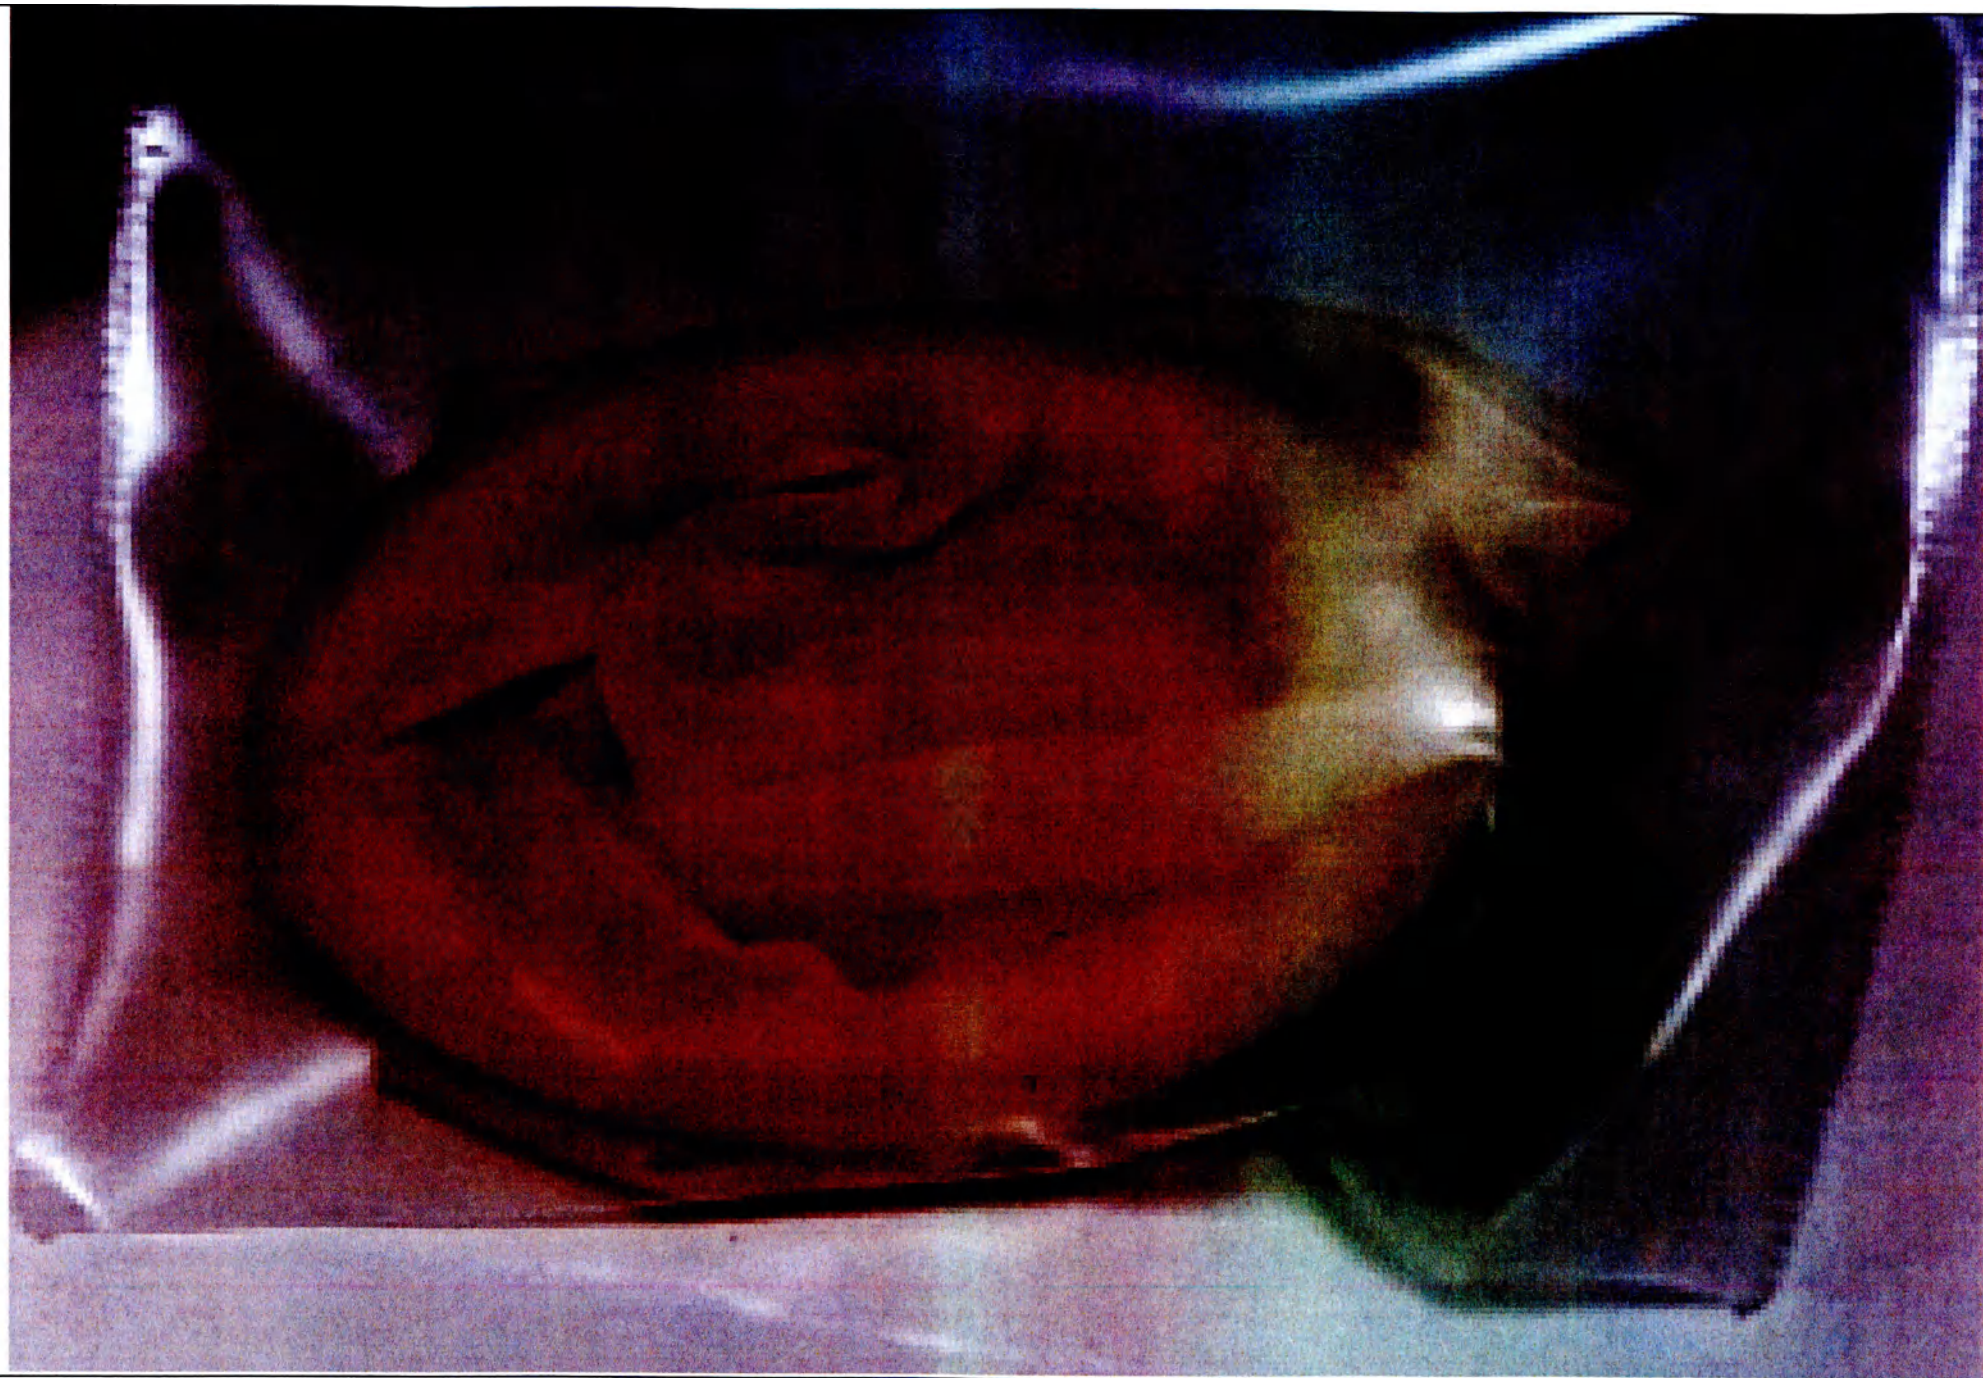


Рисунок 31b. Защитные стерильные оболочки для датчиков





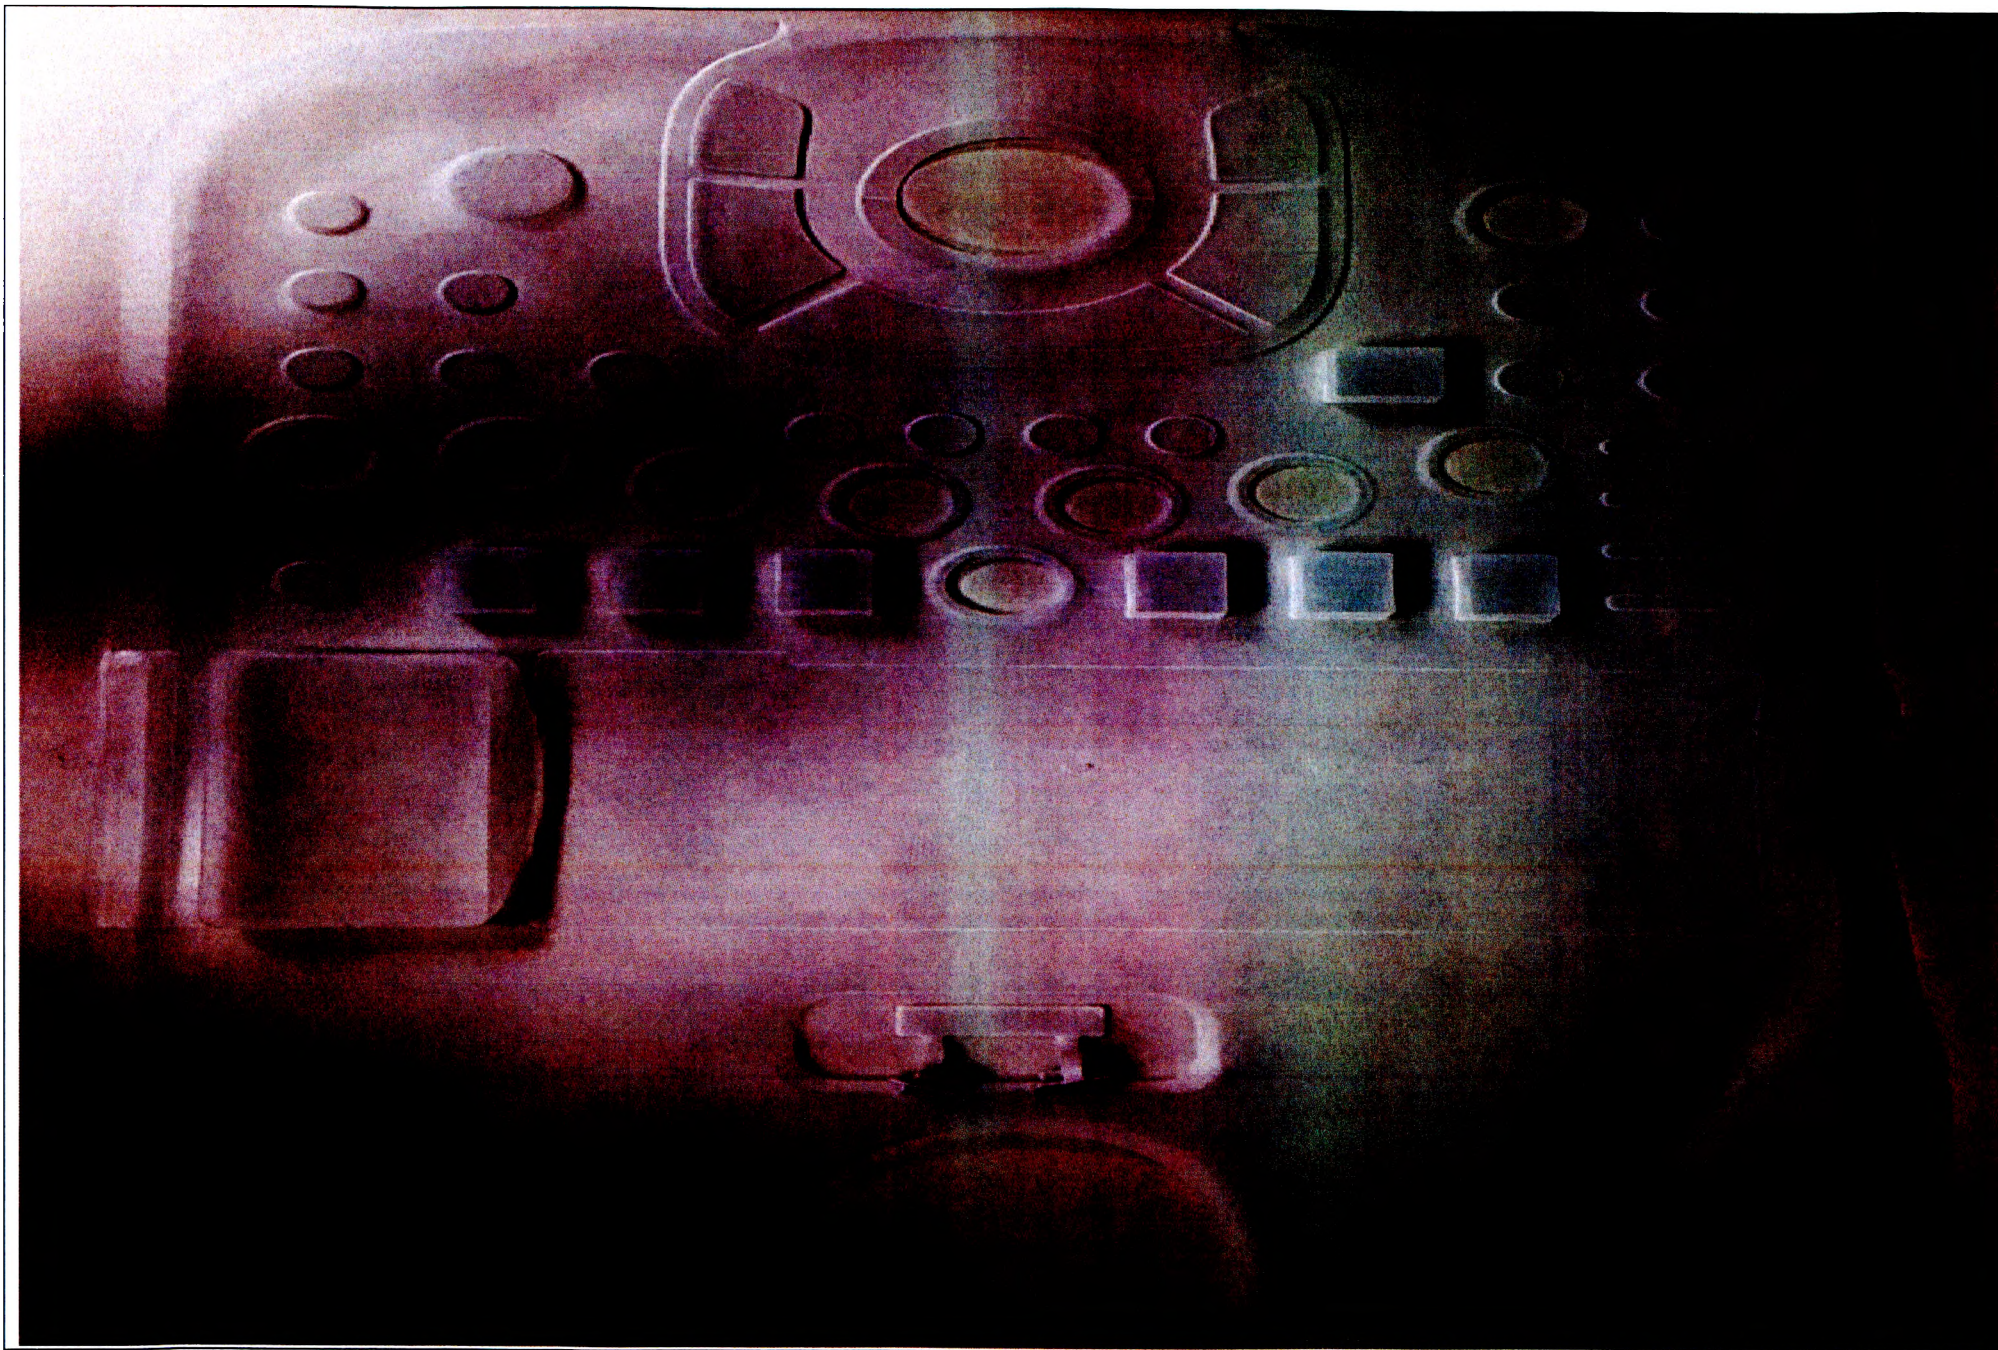
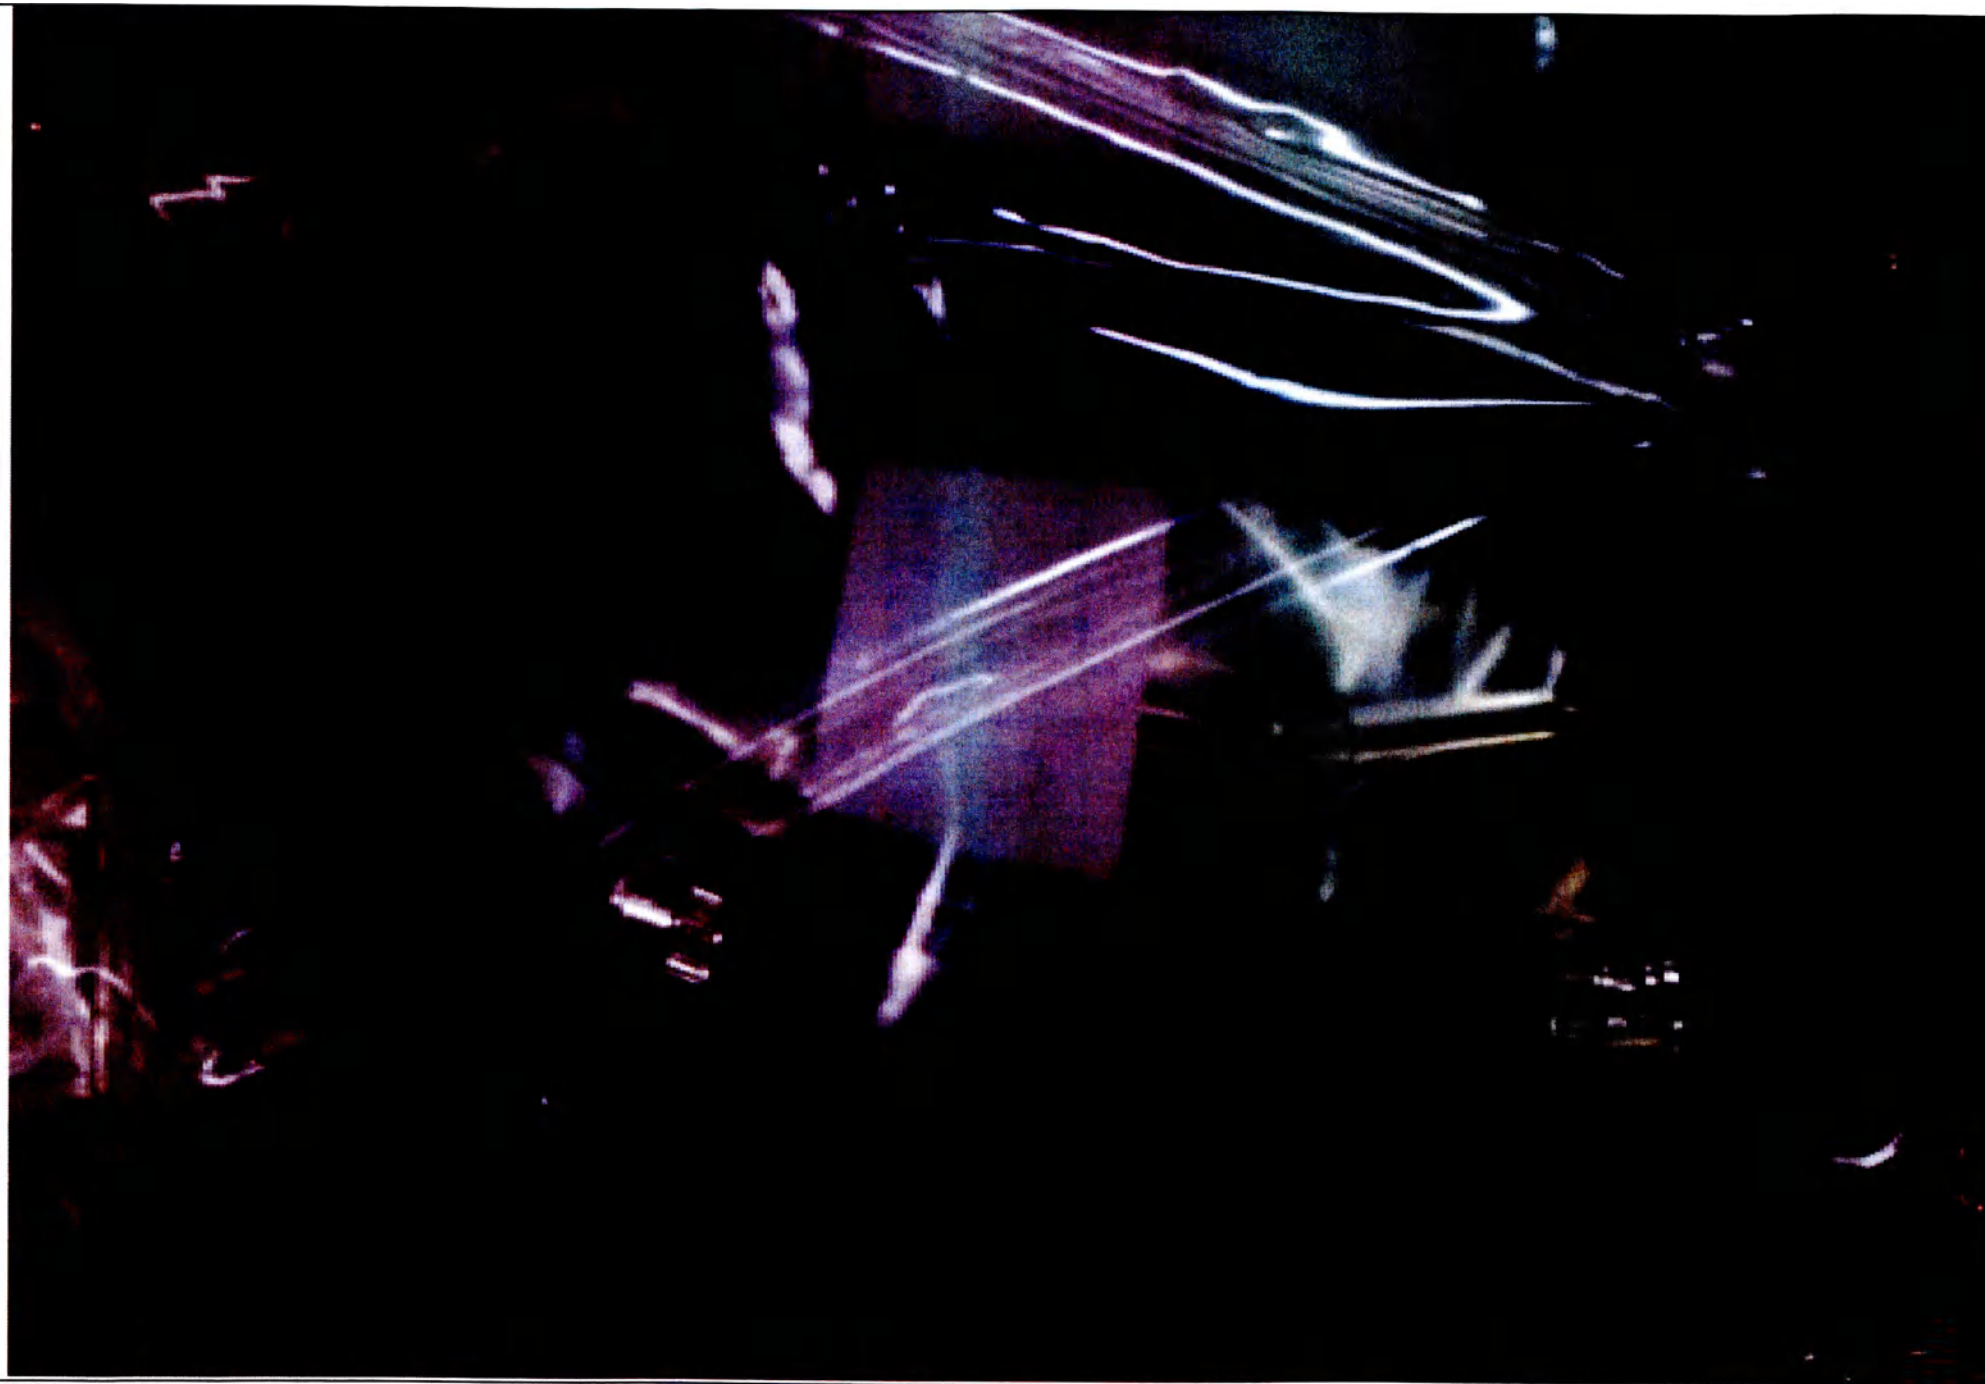


Рисунок 34. Защитная накладка для панели управления



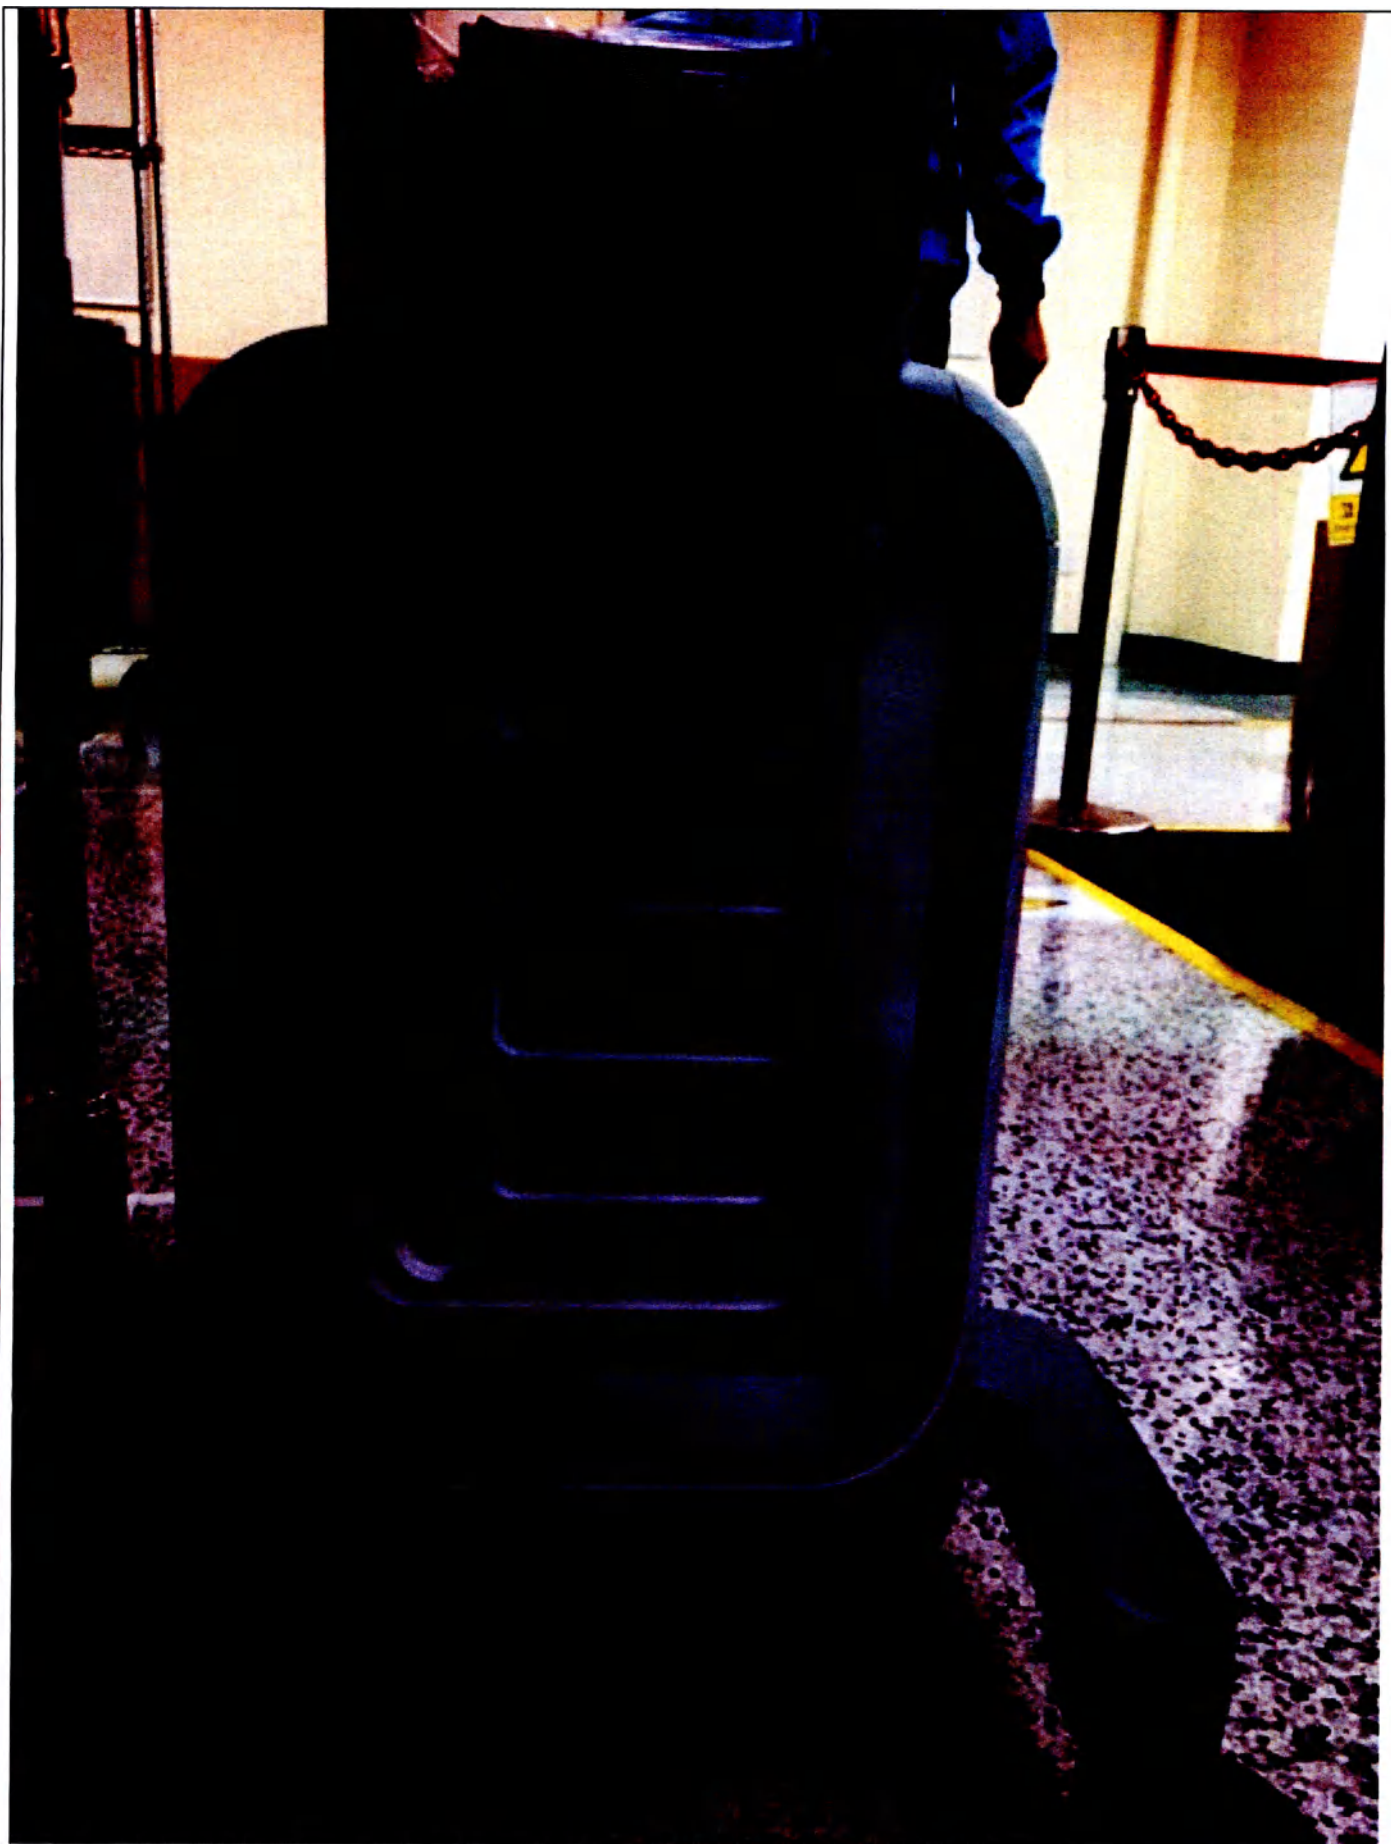
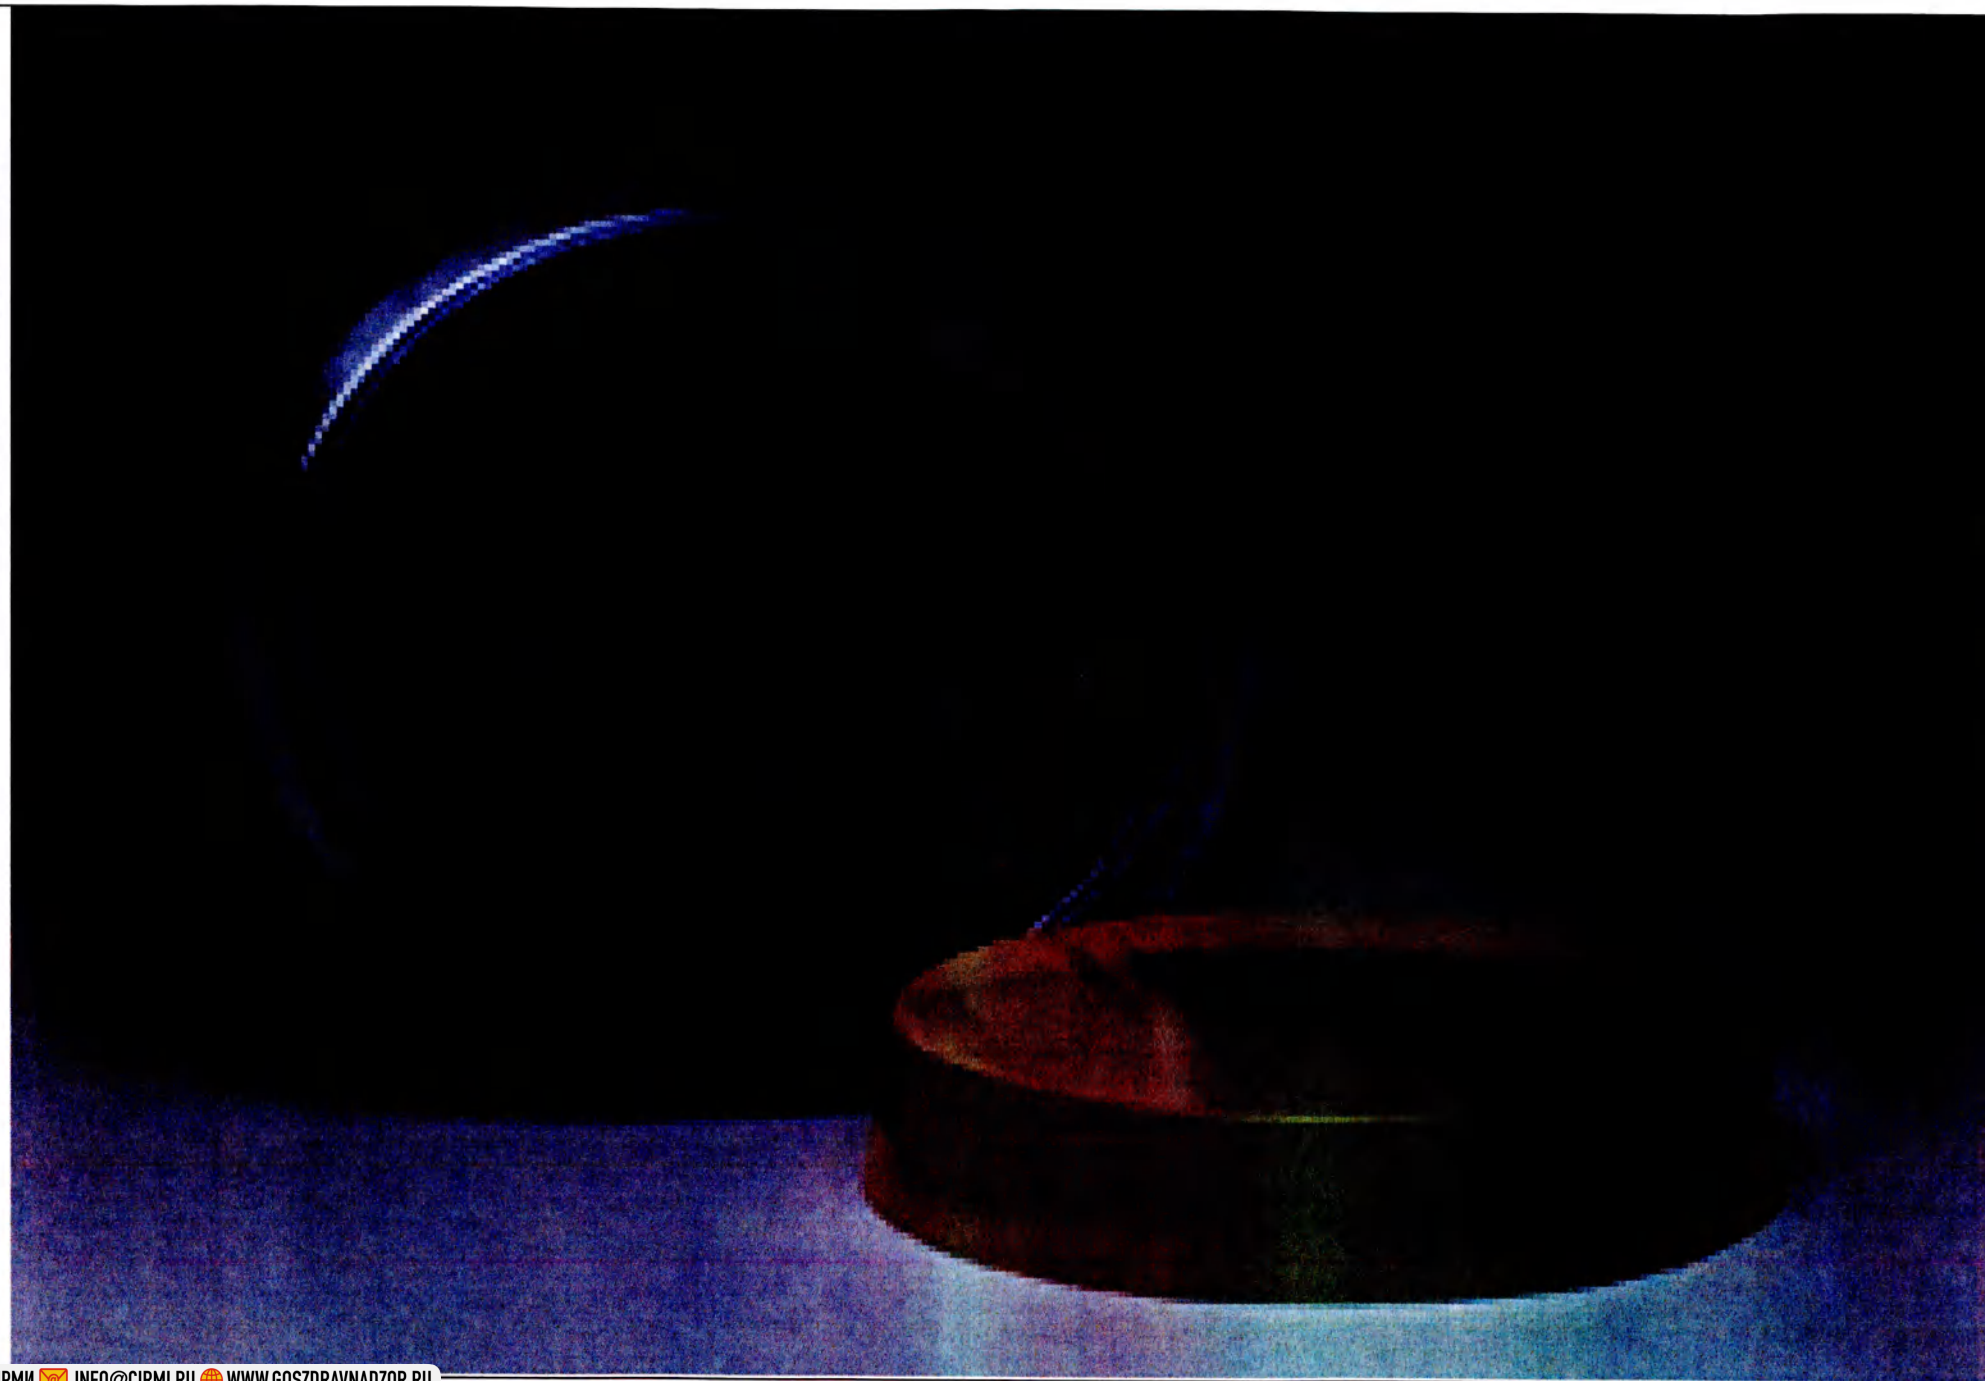


Рисунок 36. Устройства для установки периферийного оборудования





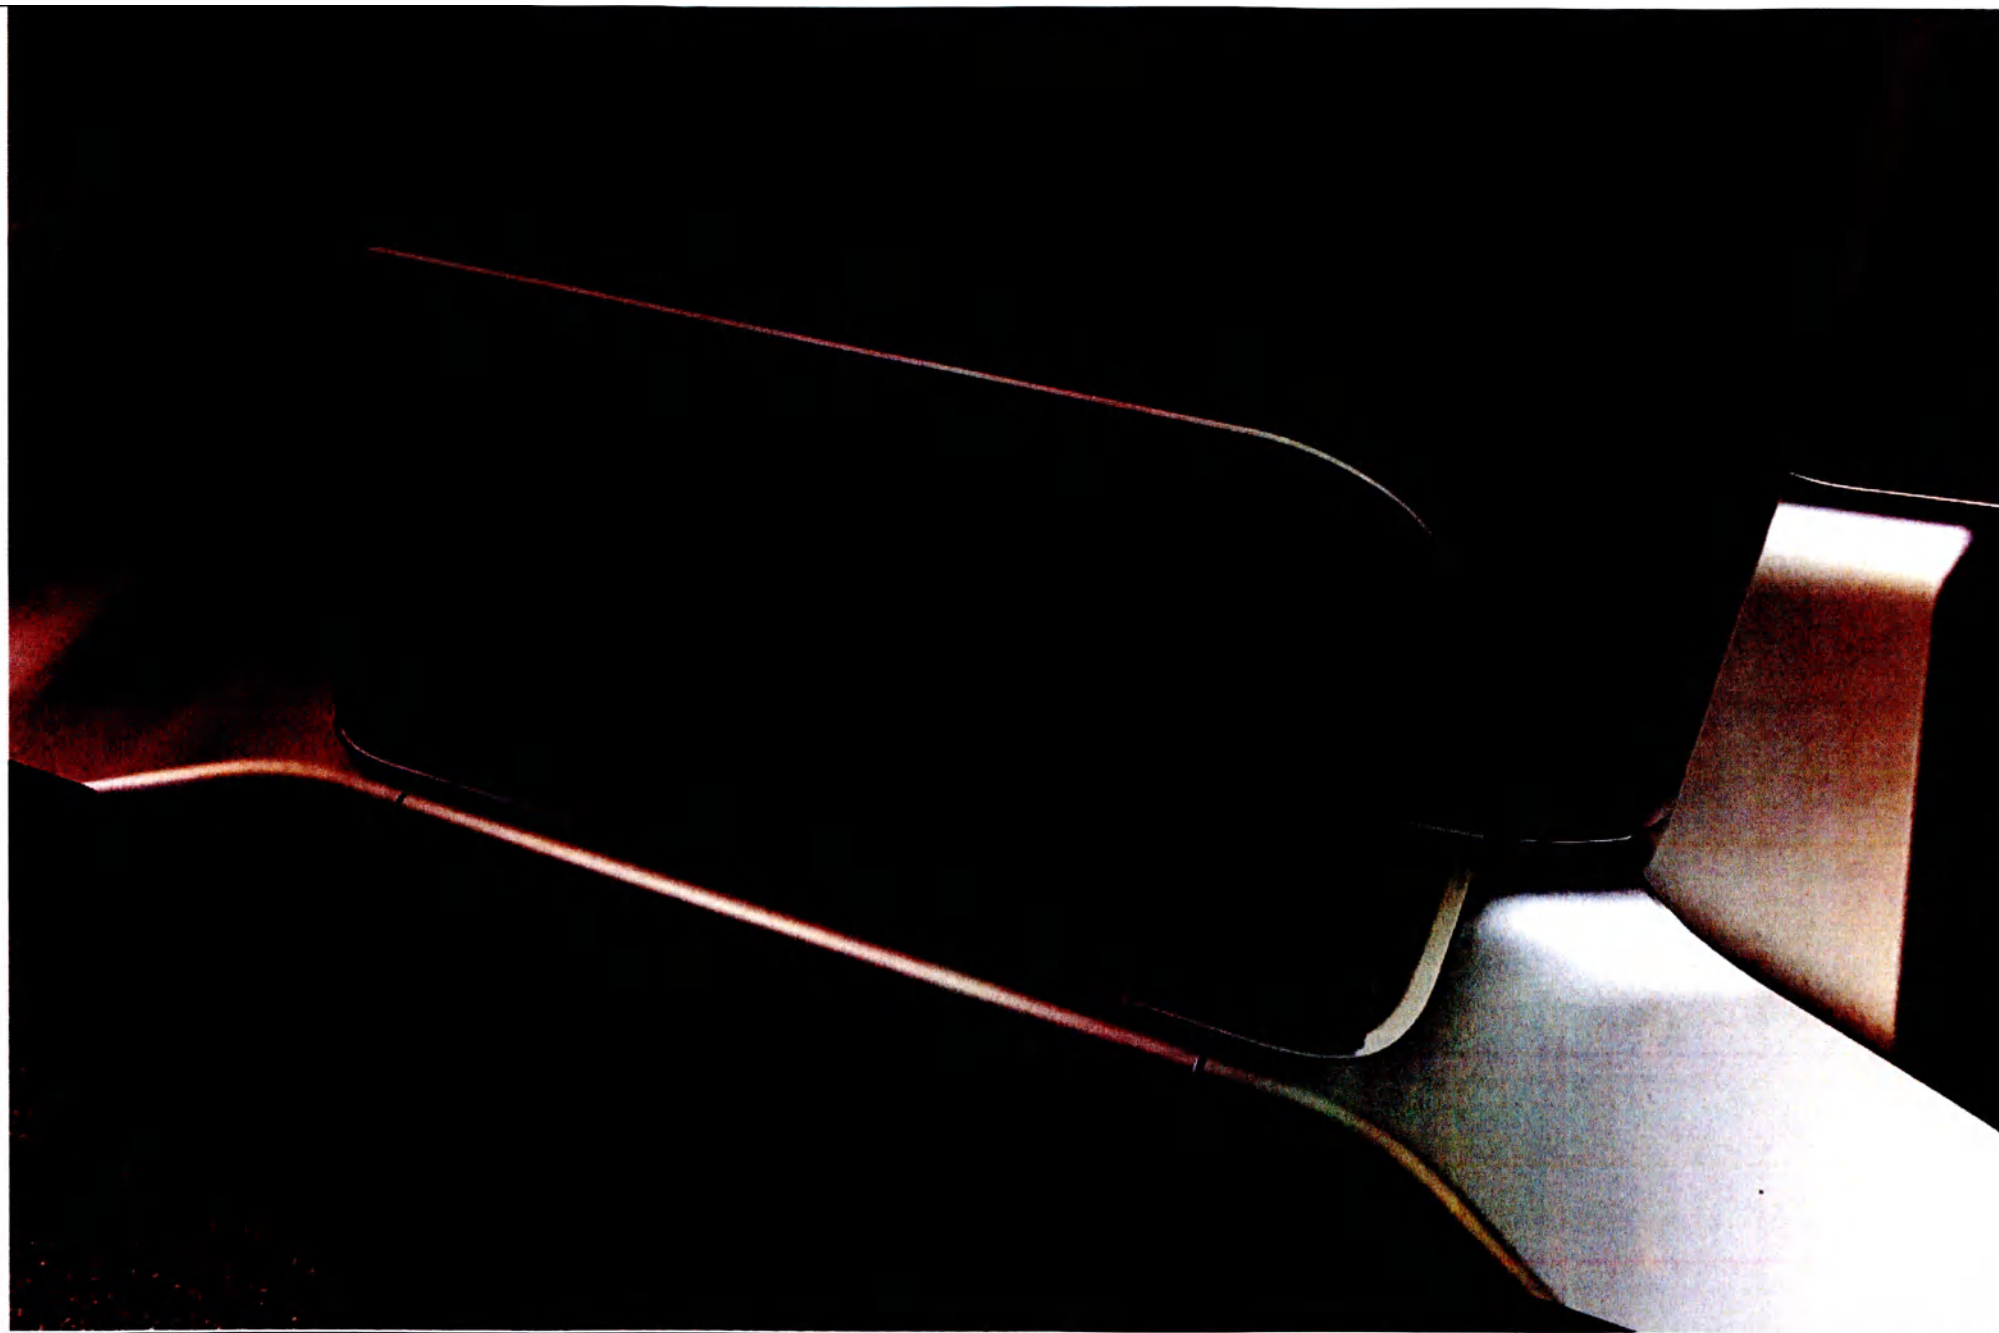


Рисунок 39. Боковой контейнер для хранения принадлежностей

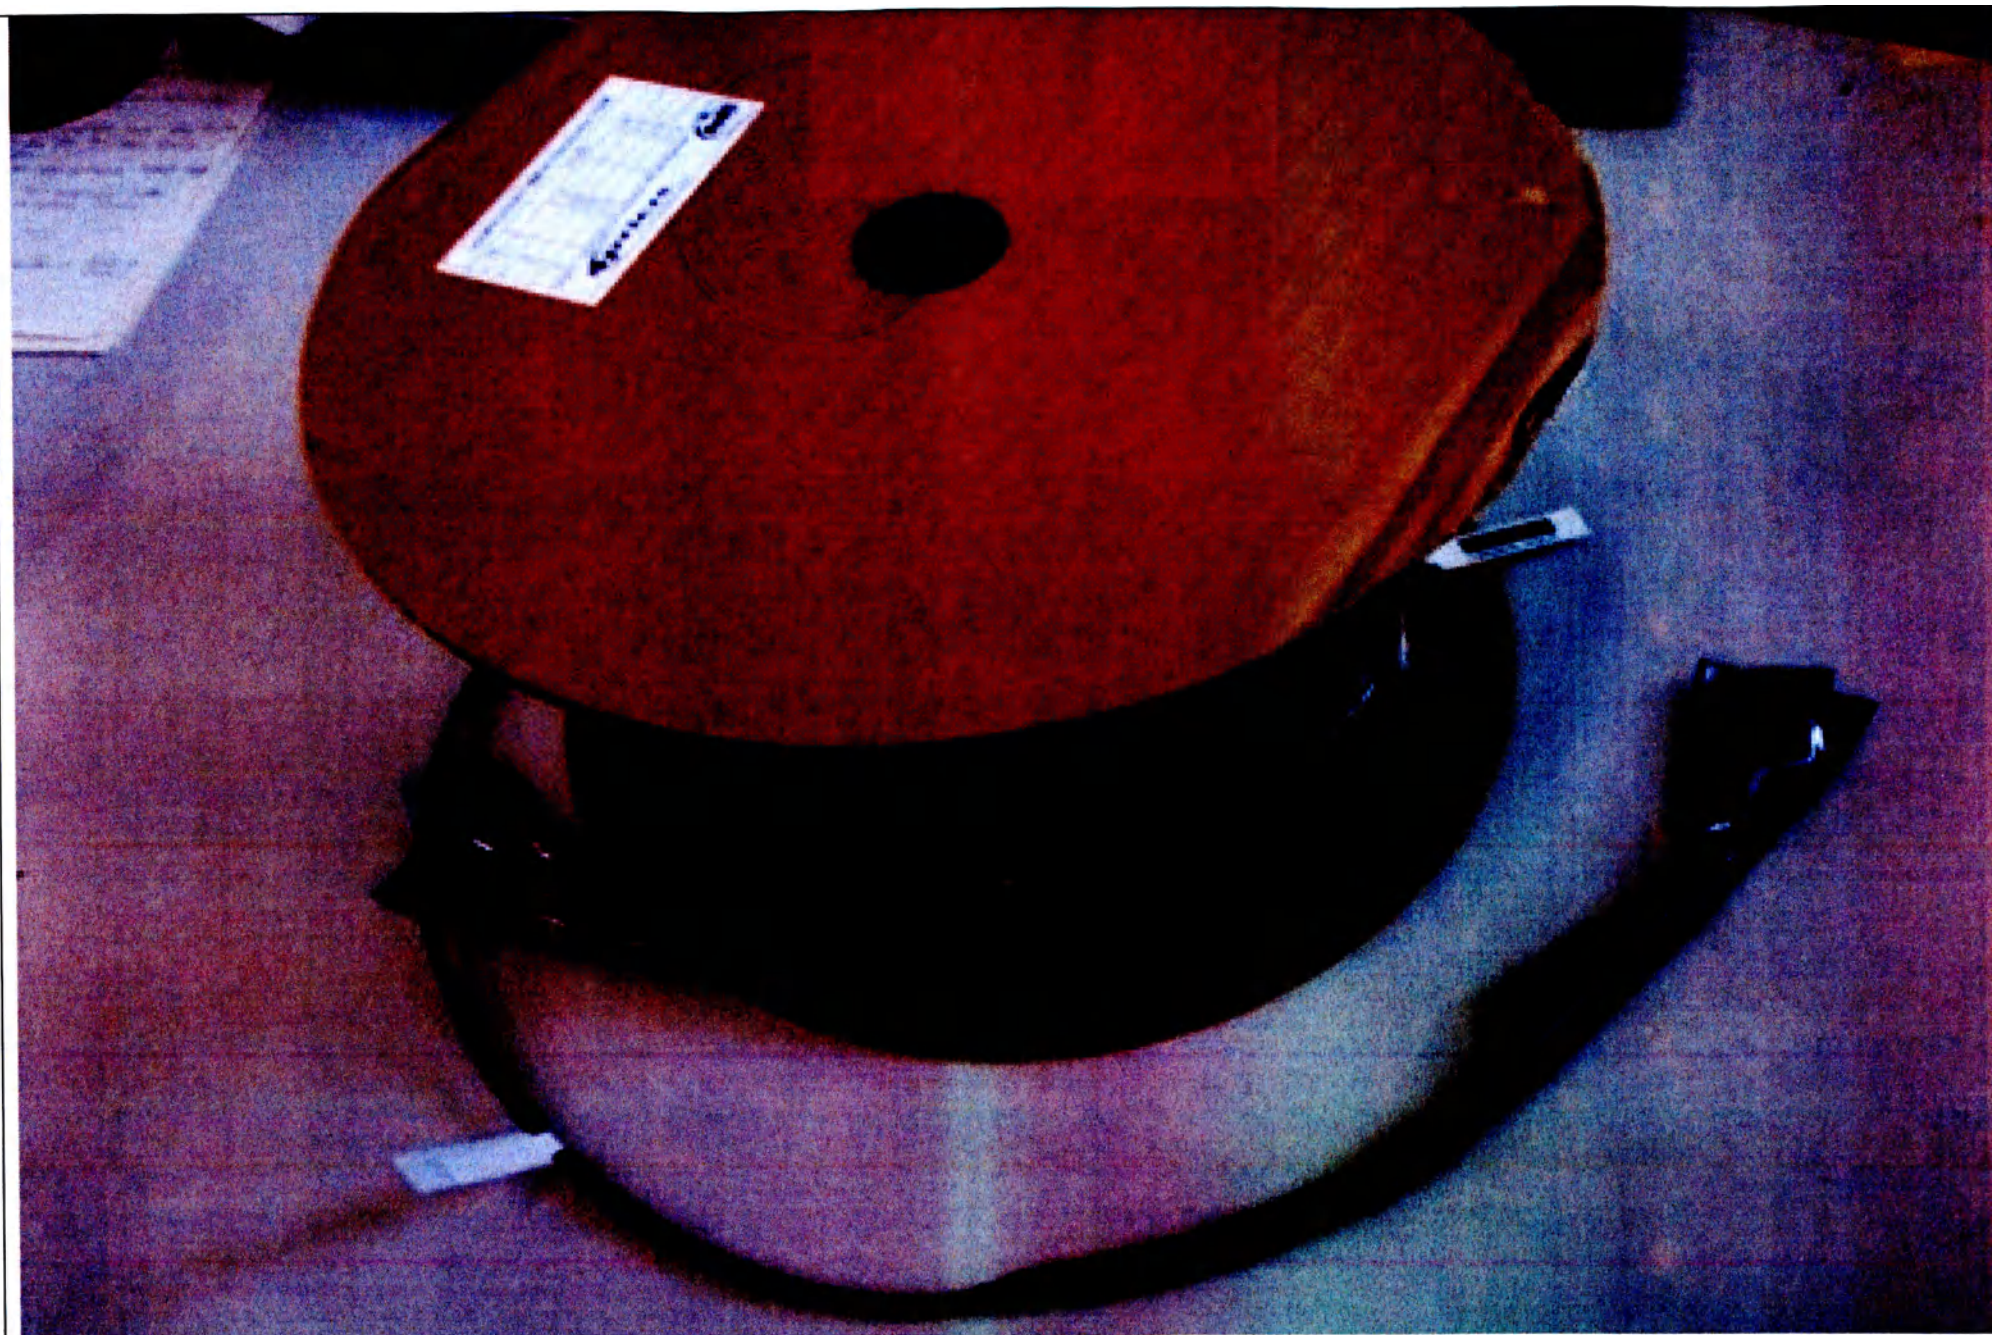


Рисунок 40. Кабели для подключения периферийного оборудования

Всего прошито и пронумеровано
120 листов.

ООО «Сименс Здравоохранение»

