

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сюнь Вэй

«12» марта 2024 г.

по доверенности от 13.12.23г
МОСКВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro

Макеты русскоязычных маркировок изделия

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на транспортную коробку изделия

Наименование	Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель территории РФ	на ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на основной блок

Наименование	Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro, в составе: 1. Основной блок
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель территории РФ	на ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет русскоязычной маркировки, наносимый на автозагрузчик SDM

Наименование	Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro, в составе: 19. Автозагрузчик SDM
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Уполномоченный представитель территории РФ	на ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Наименование	Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro, в составе: 30. Внешний модуль подачи воды	
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)	
Уполномоченный представитель территории РФ	на	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.	

Наименование	Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro, в составе: 31. Компрессор воздушный внешний	
Производитель	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)	
Уполномоченный представитель территории РФ	на	ООО «Миндрей Медикал Рус» 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мешанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.	

**Анализатор биохимический автоматический BS-2800M для диагностики in vitro, в составе:
Основной блок**



Маркировка основного блока, наносимая на заднюю панель.

Analyzing Module

mindray

SN



BH2-38000269T



2023-09-05

220-240V ~ 50Hz 4500VA

220/230V ~ 60Hz 4500VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-045505-00(1 0)



Chemistry Analyzer

mindray

Model: BS-2800M

SN



BH2-38000269T



2023-09-05

Power supply: See the labels of each module for details.



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-045506-00(1 0)


UDI



(01)06903053062510

(11)230905

(21)BH2-38000269T



IVD

1/2

BS-2800M/BS-2600M

Chemistry Analyzer

Operator's Manual

Volume I

mindray

2/2

BS-2800M/BS-2600M

Chemistry Analyzer

Operator's Manual

Volume II

mindray

Operating Software of BS-2800M/BS-2600M
Series Chemistry Analyzer

Ver: *V03.01.19*

NOTE:

Before installation, ensure that the computer and operating system meet the requirements of the operating software. Refer to the Operator's Manual for more information.

mindray

047-035453-00(1.0)

© 2012 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved

Manufactured by Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Address: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680


<http://www.mindray.com>

CD - диск с программным обеспечением

USB-флеш-накопитель с программным обеспечением



USB-флеш-накопитель с программным обеспечением для сервисного обслуживания

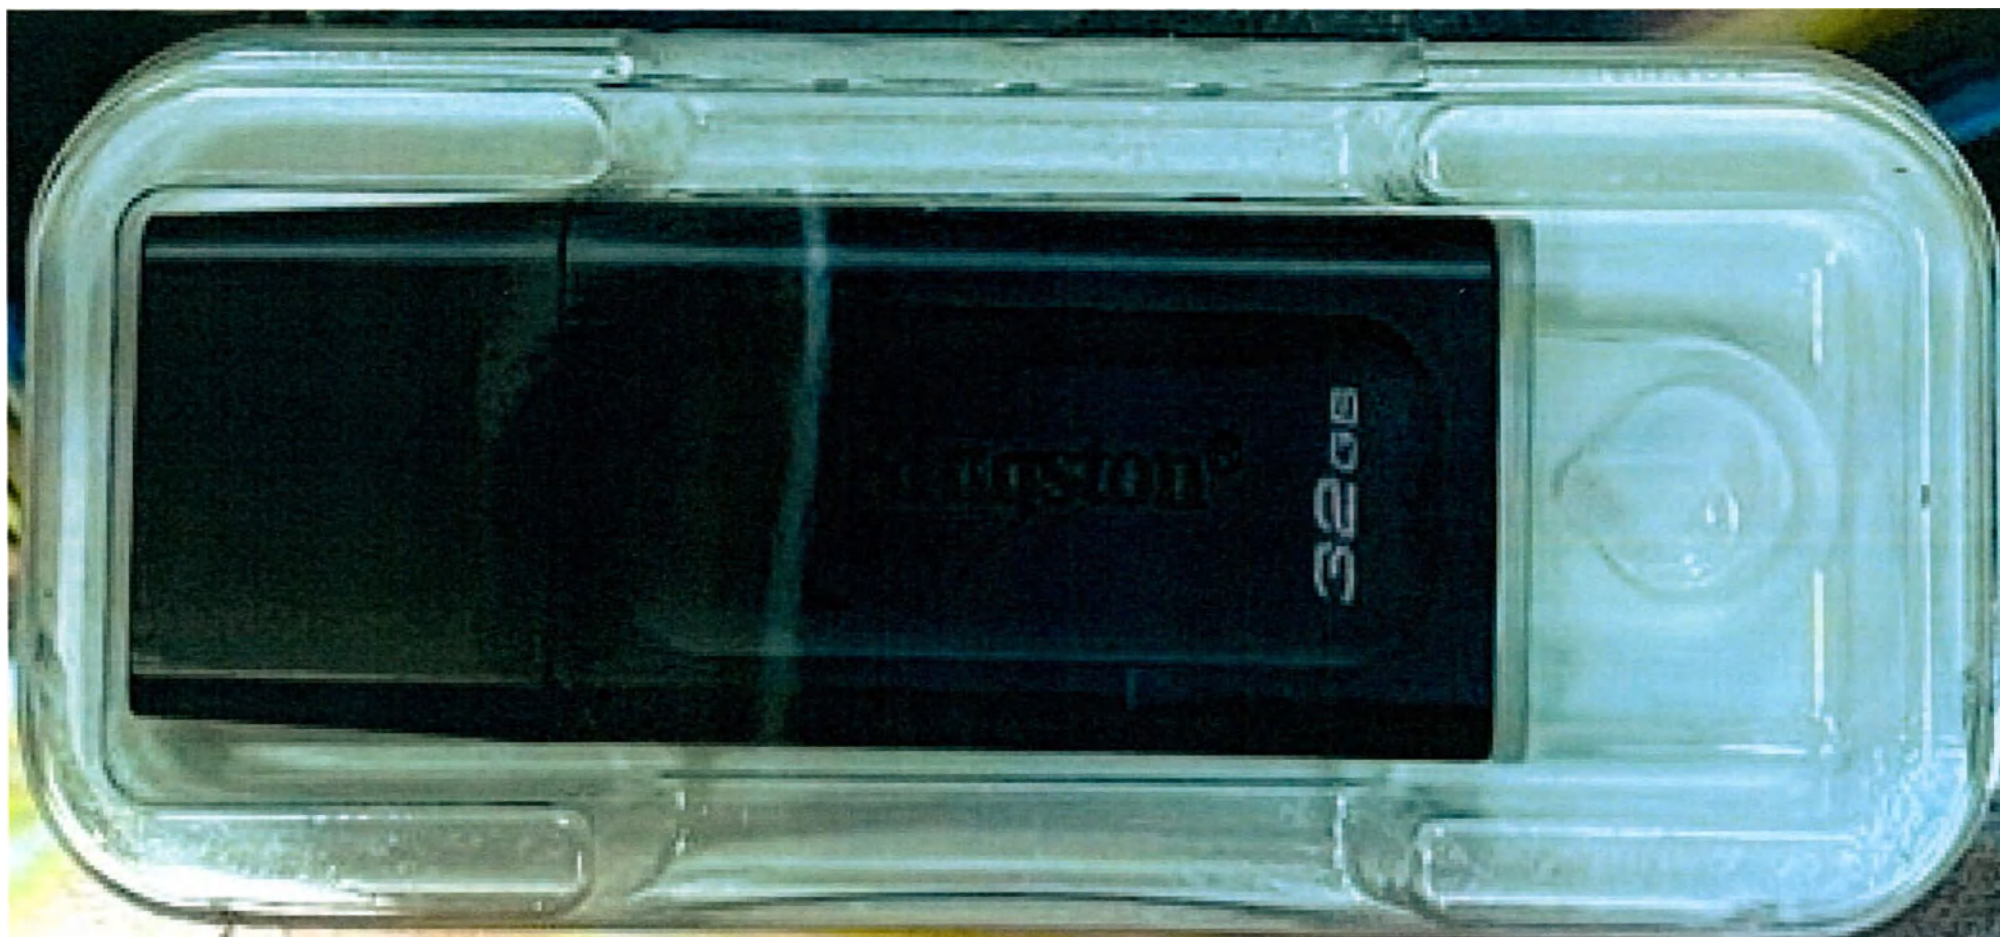


Кабель питания с изолированными наконечниками для подключения сети переменного тока




Кабель питания для подключения к сети переменного тока



Кабель сетевой

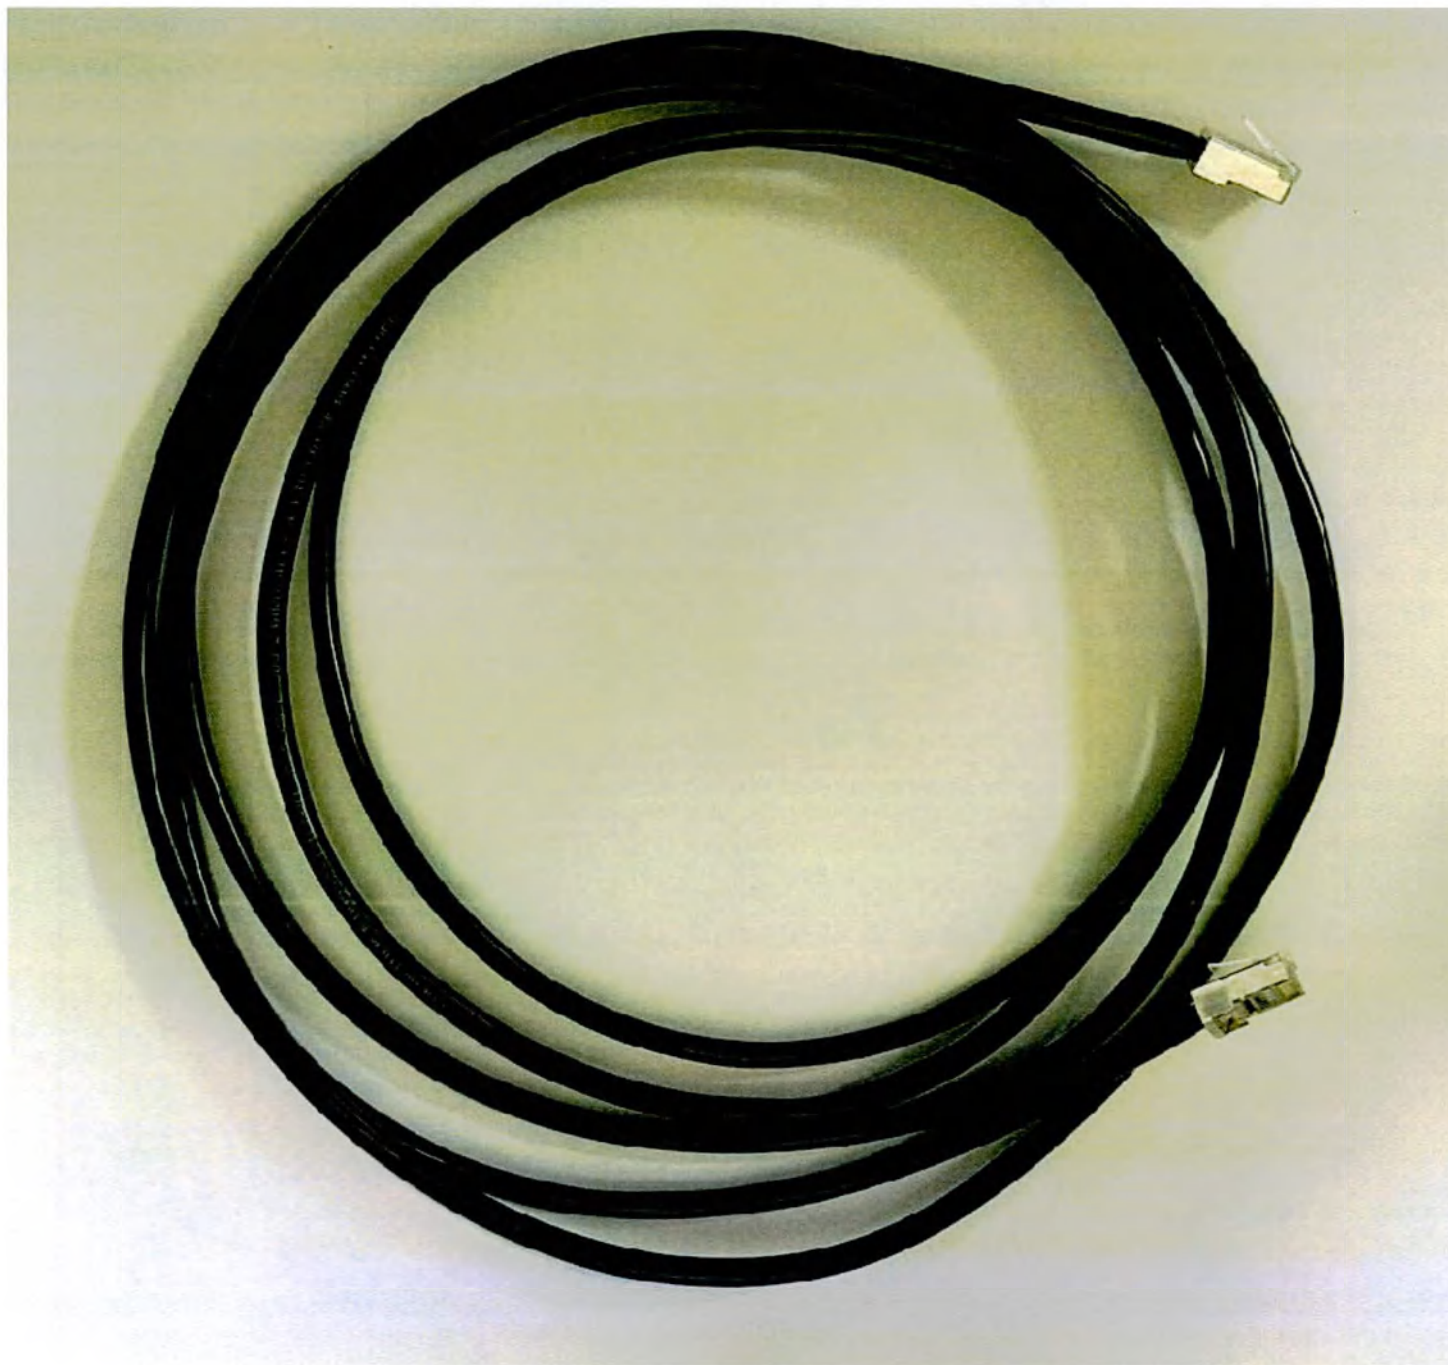

Трубка ПВХ, 12*18 мм

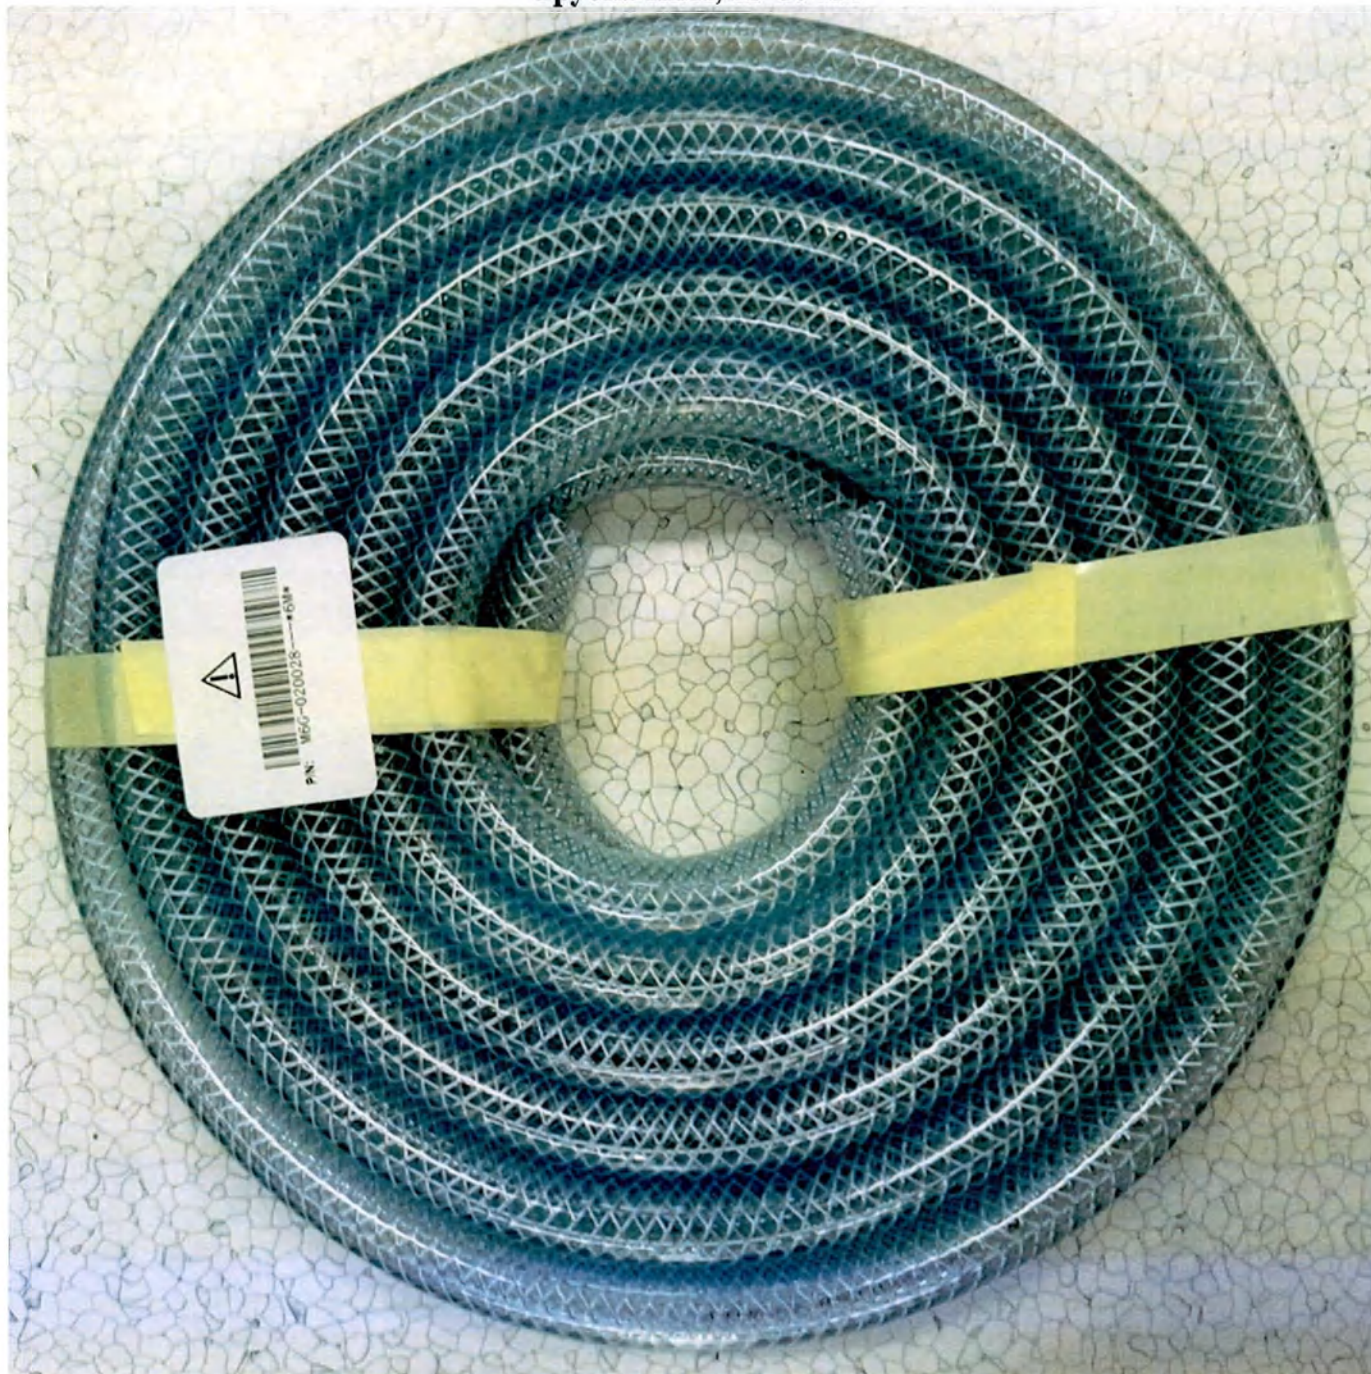

Кабель компрессора соединительный



Канал для укладки кабелей



Автозагрузчик SDM



Sample Delivery Module


Model: SPL 3000

SN



BJ4-39000233T

mindray



2023-09-05


220-240V ~ 50Hz 800VA

220/230V ~ 60Hz 800VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan.
Shenzhen, 518057, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-044631-00(2.0)




Монитор, в составе:
Монитор







Панель крепежная

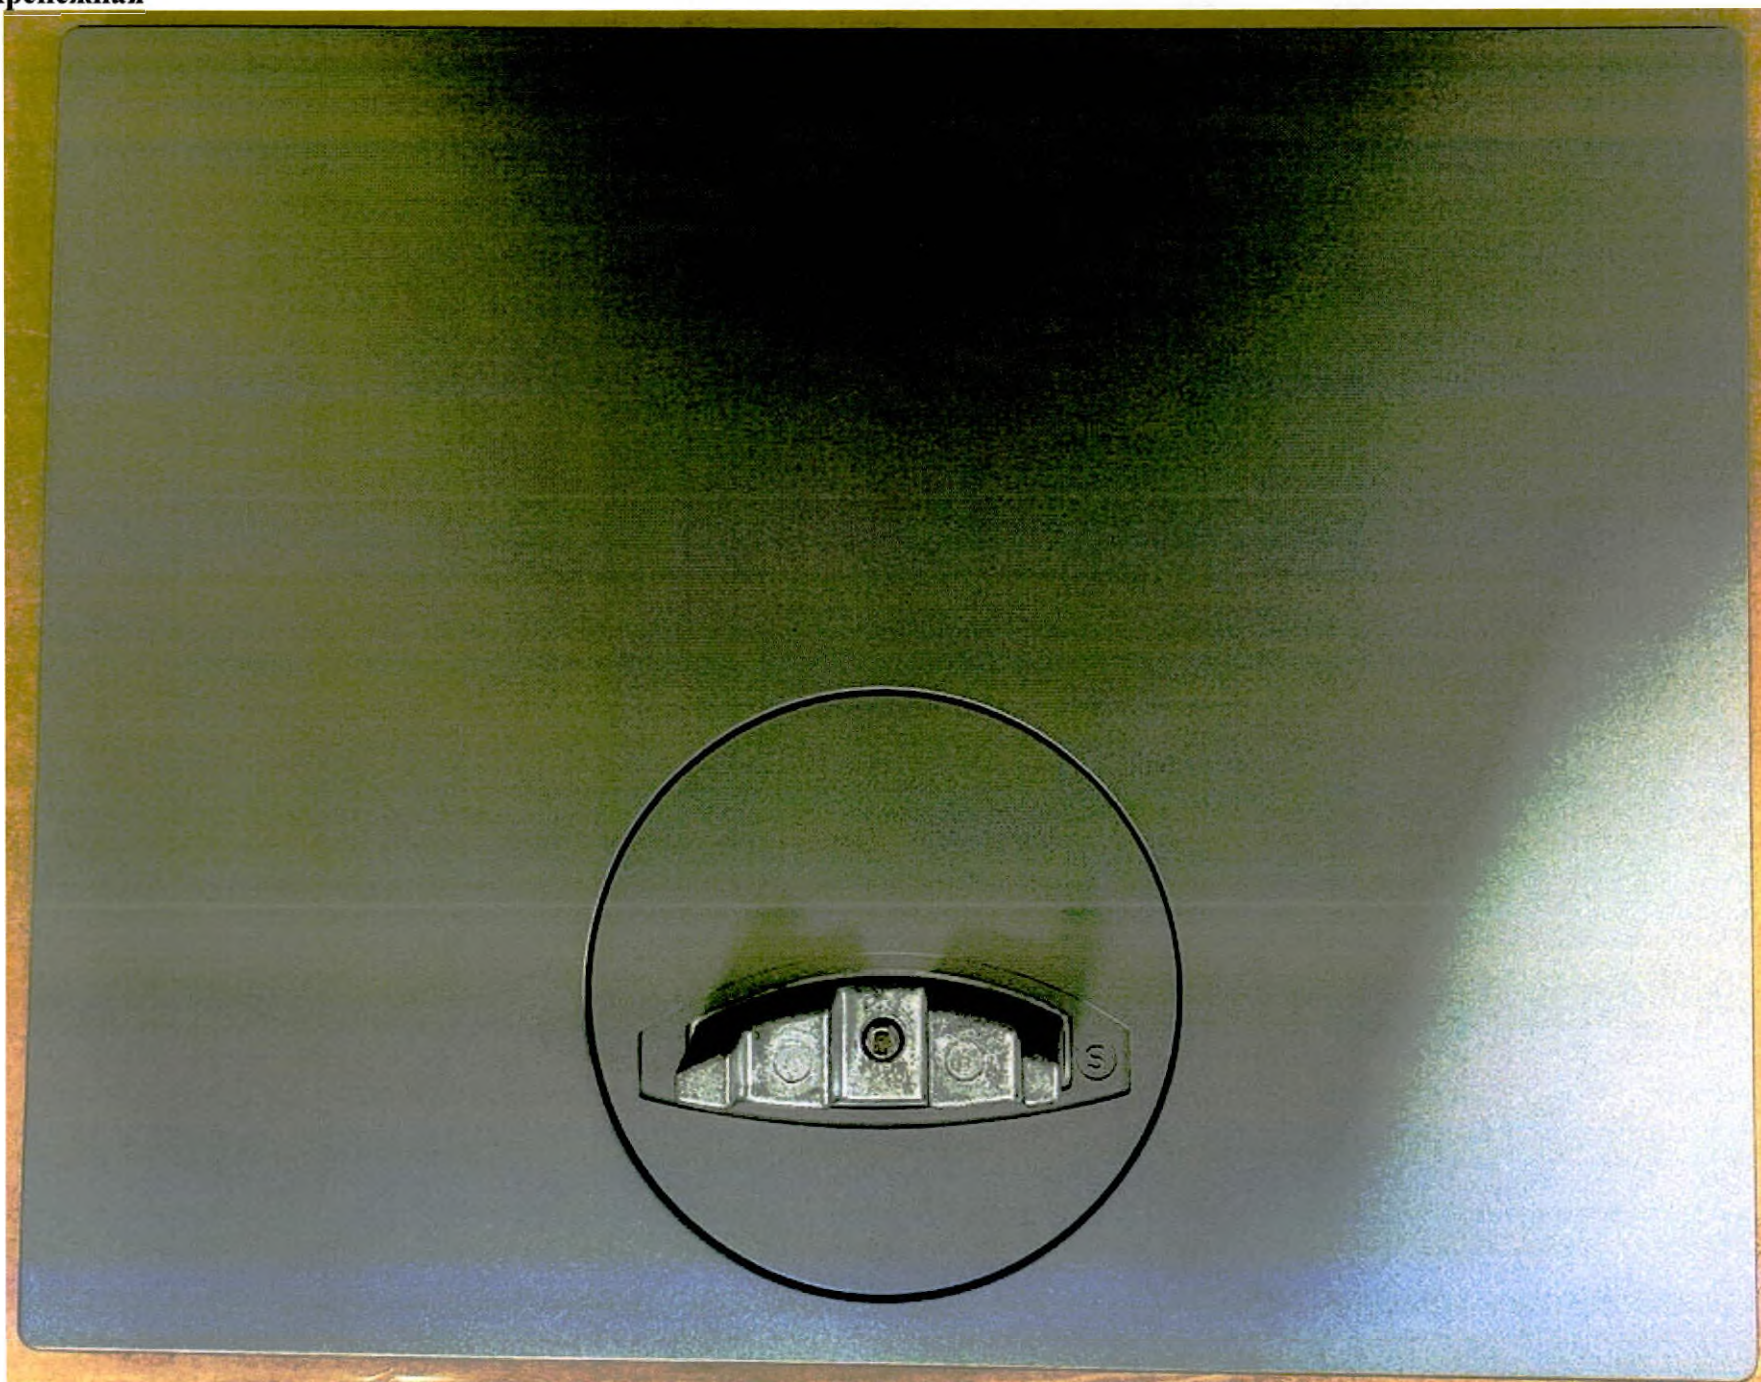

Панель декоративная

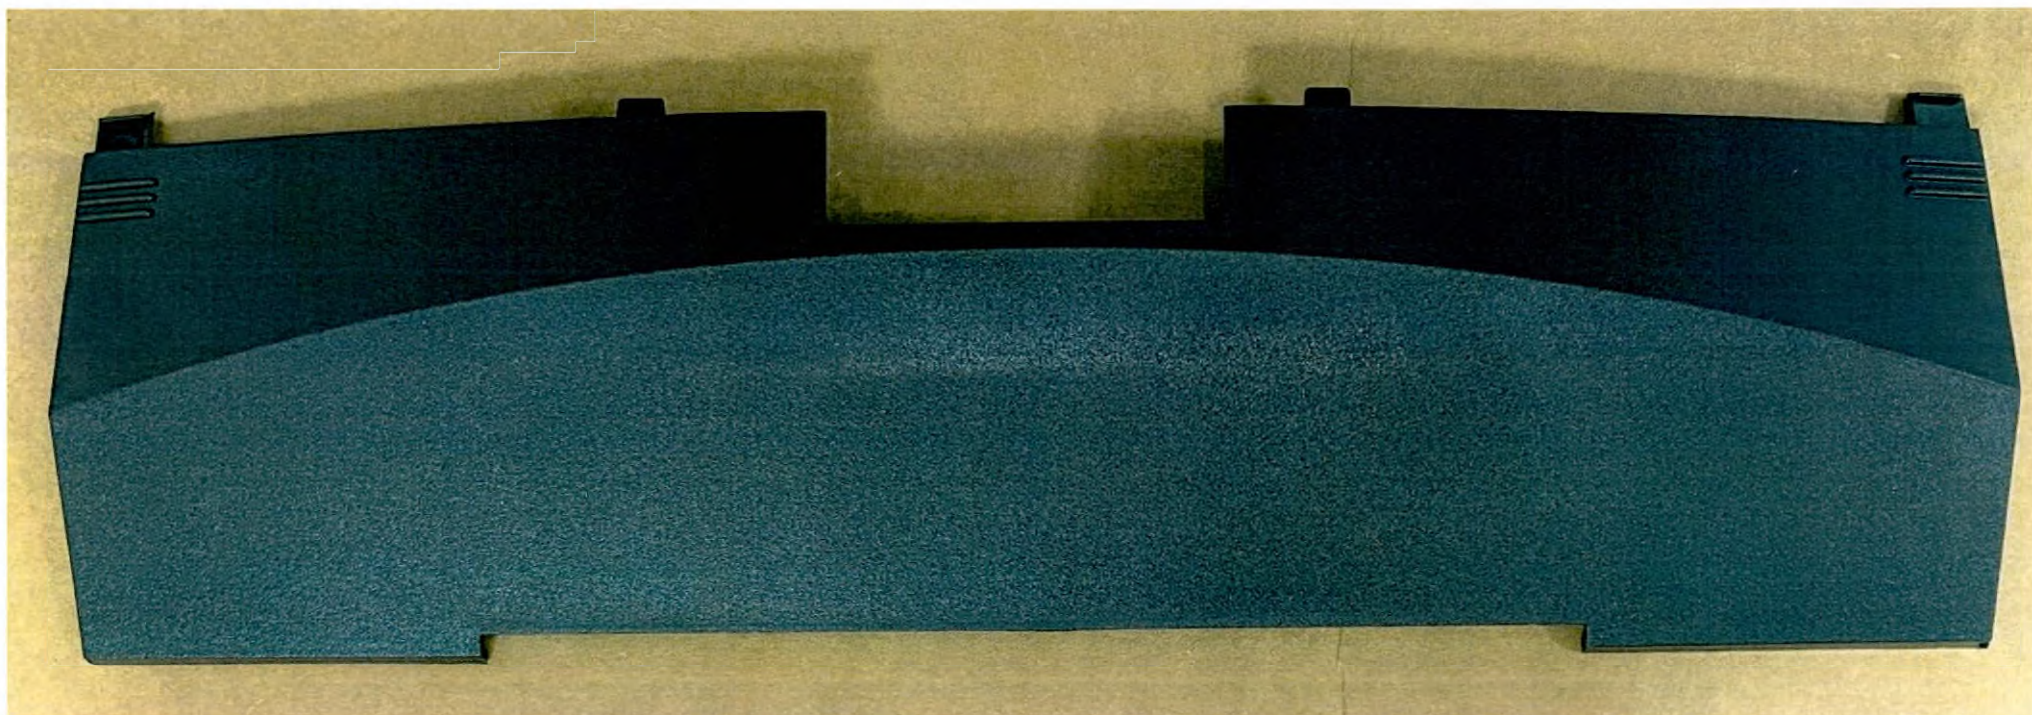

Кабель USB

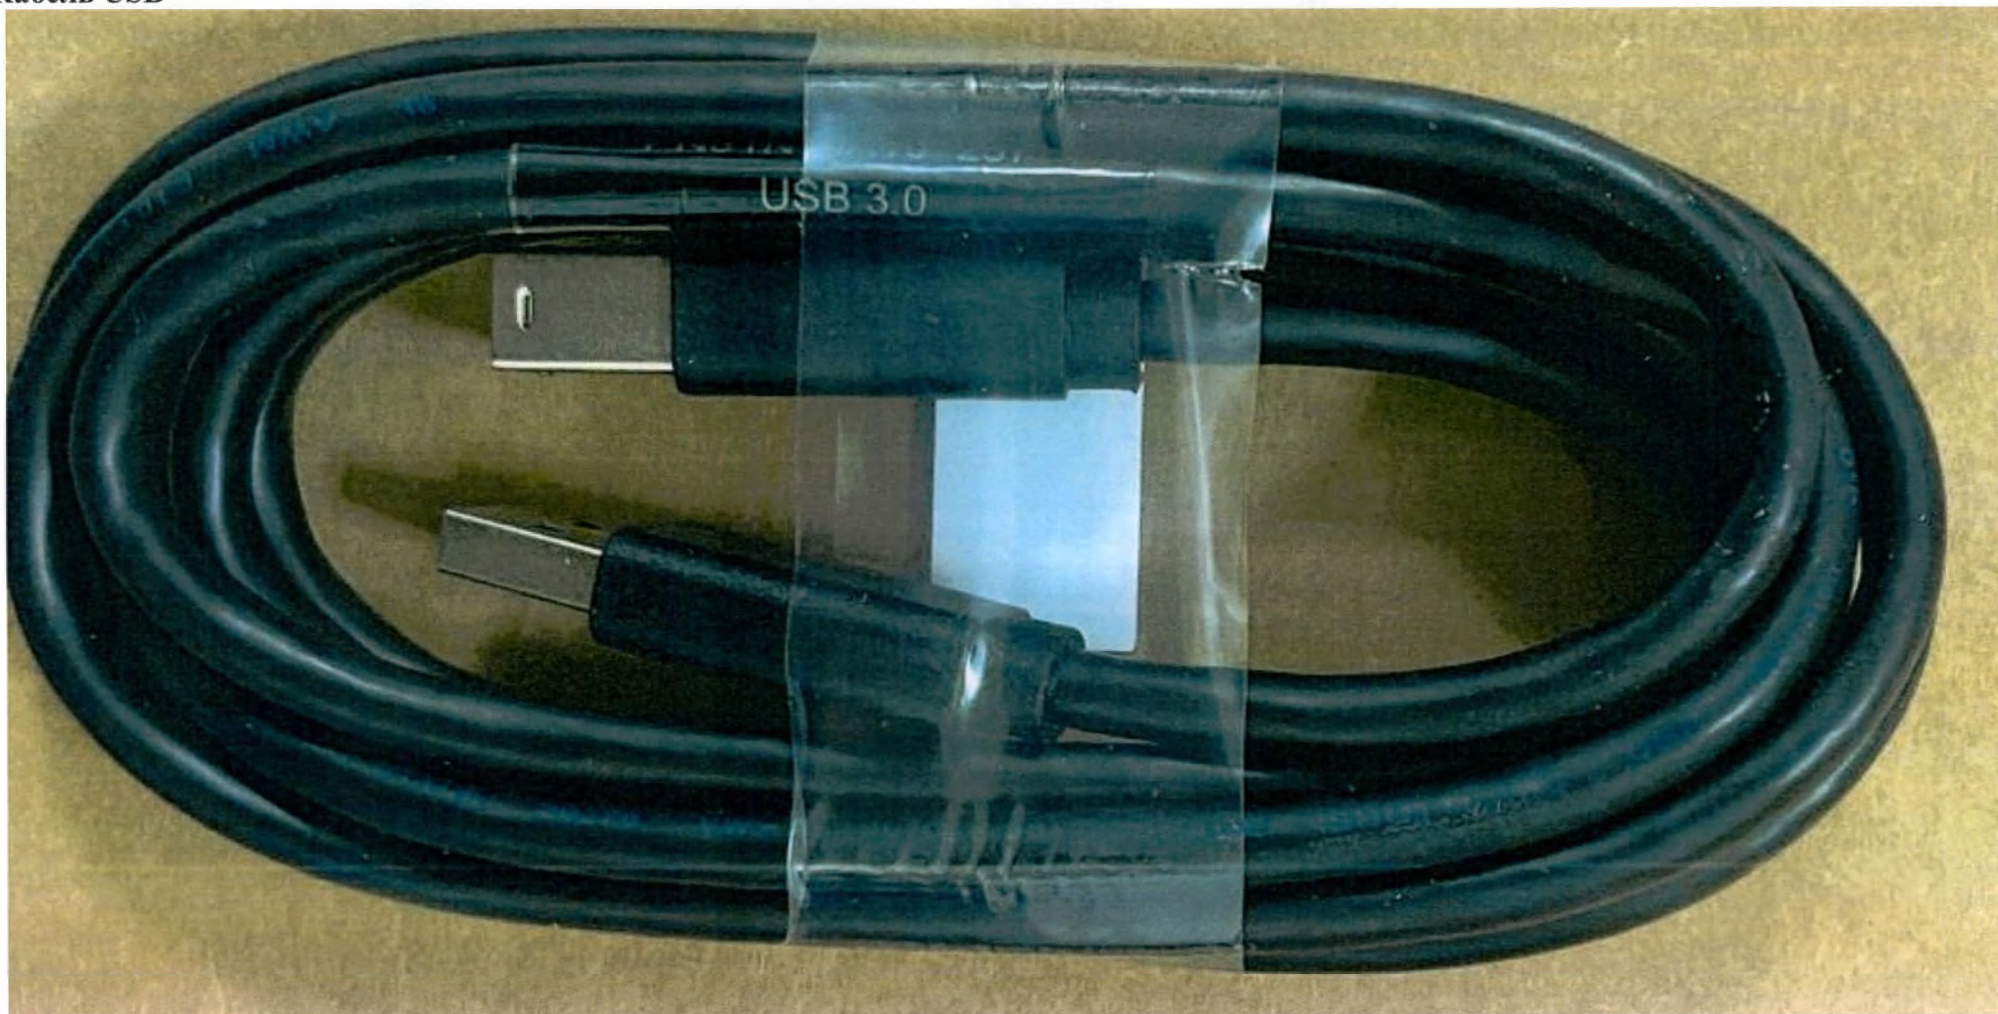

CAN-кабель





Чехол

Держатель монитора




Кронштейн монитора




Фиксатор монитора опорный




Пластина монтажная для установки монитора

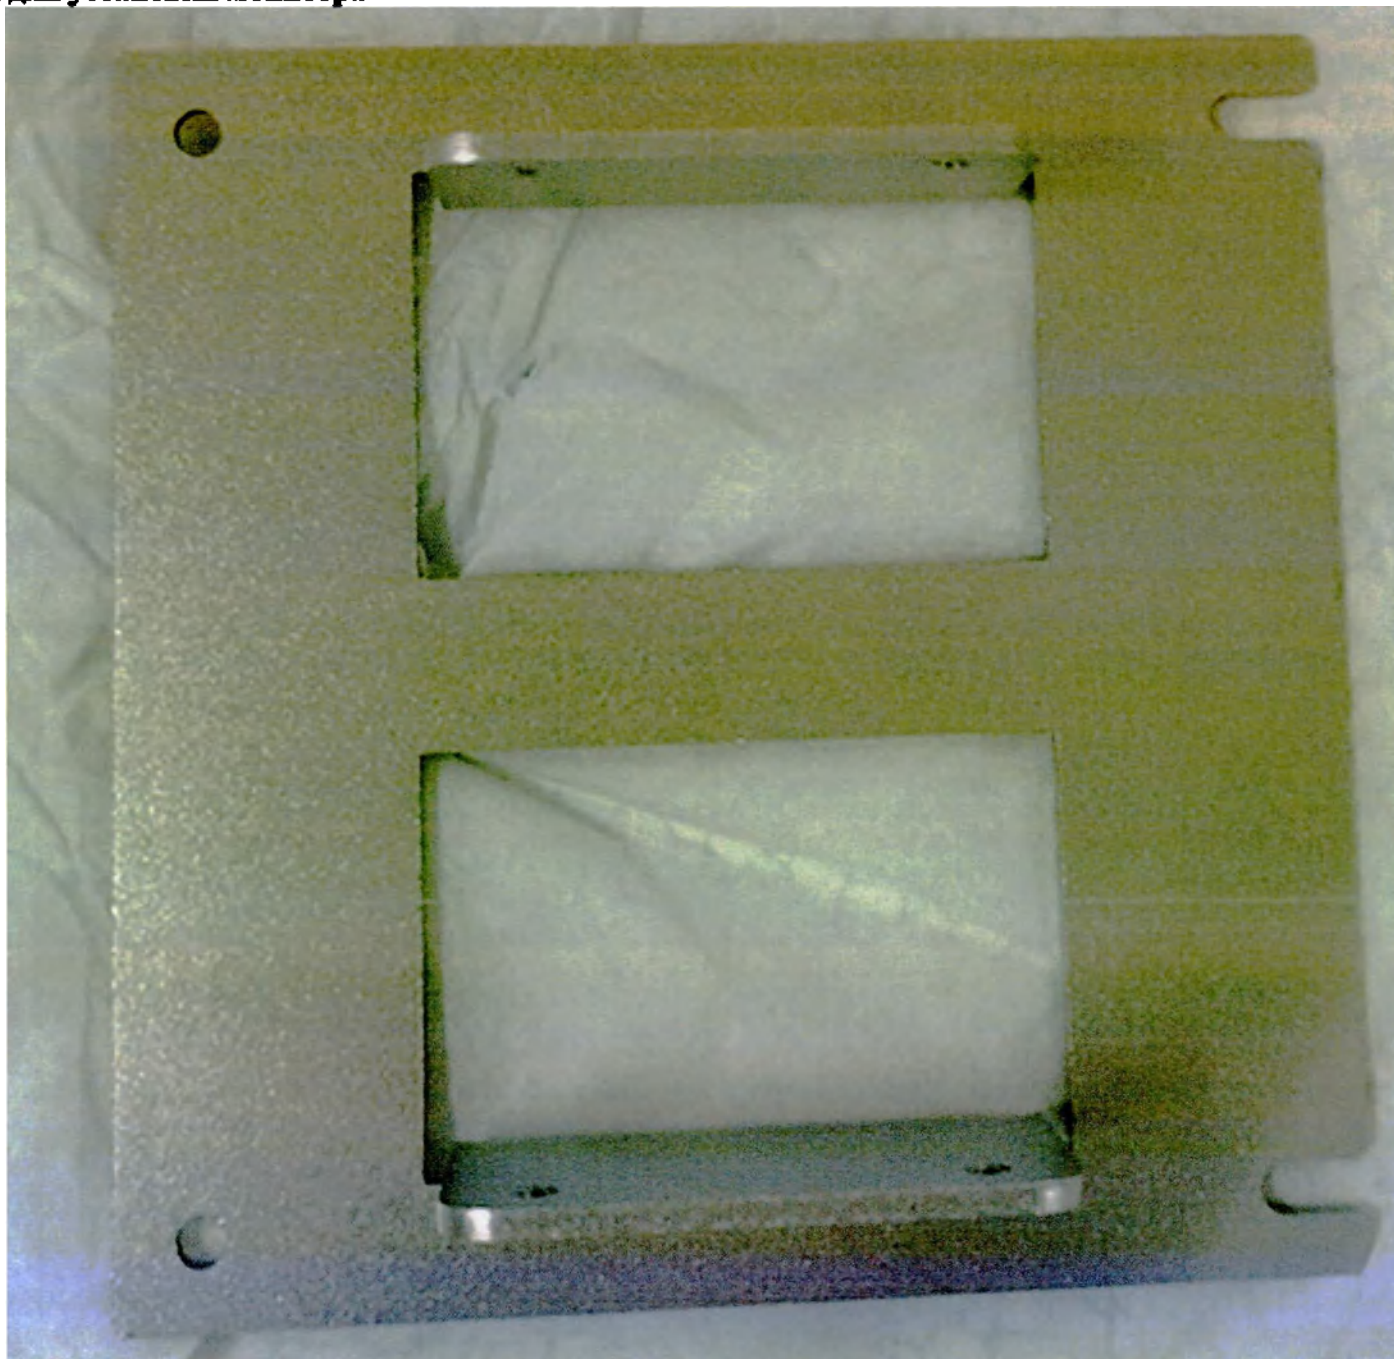


Полка для клавиатуры и мыши стандартная

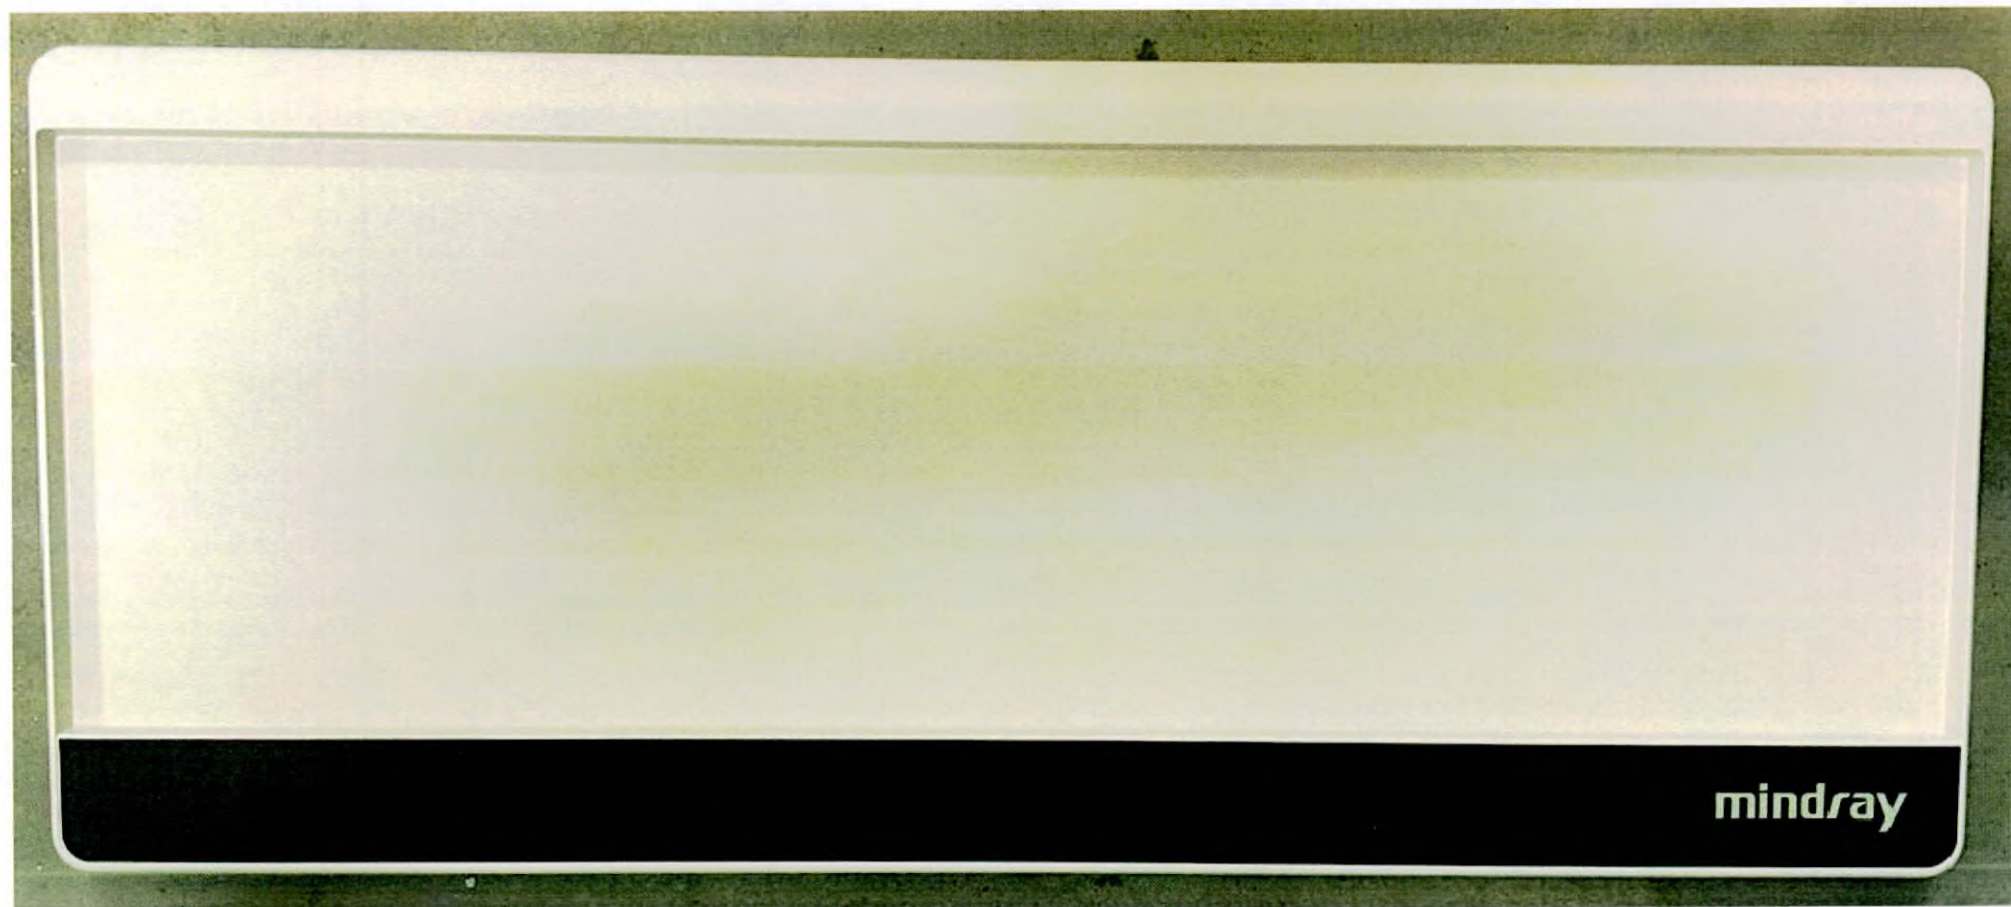

Полка для клавиатуры и мыши усиленная

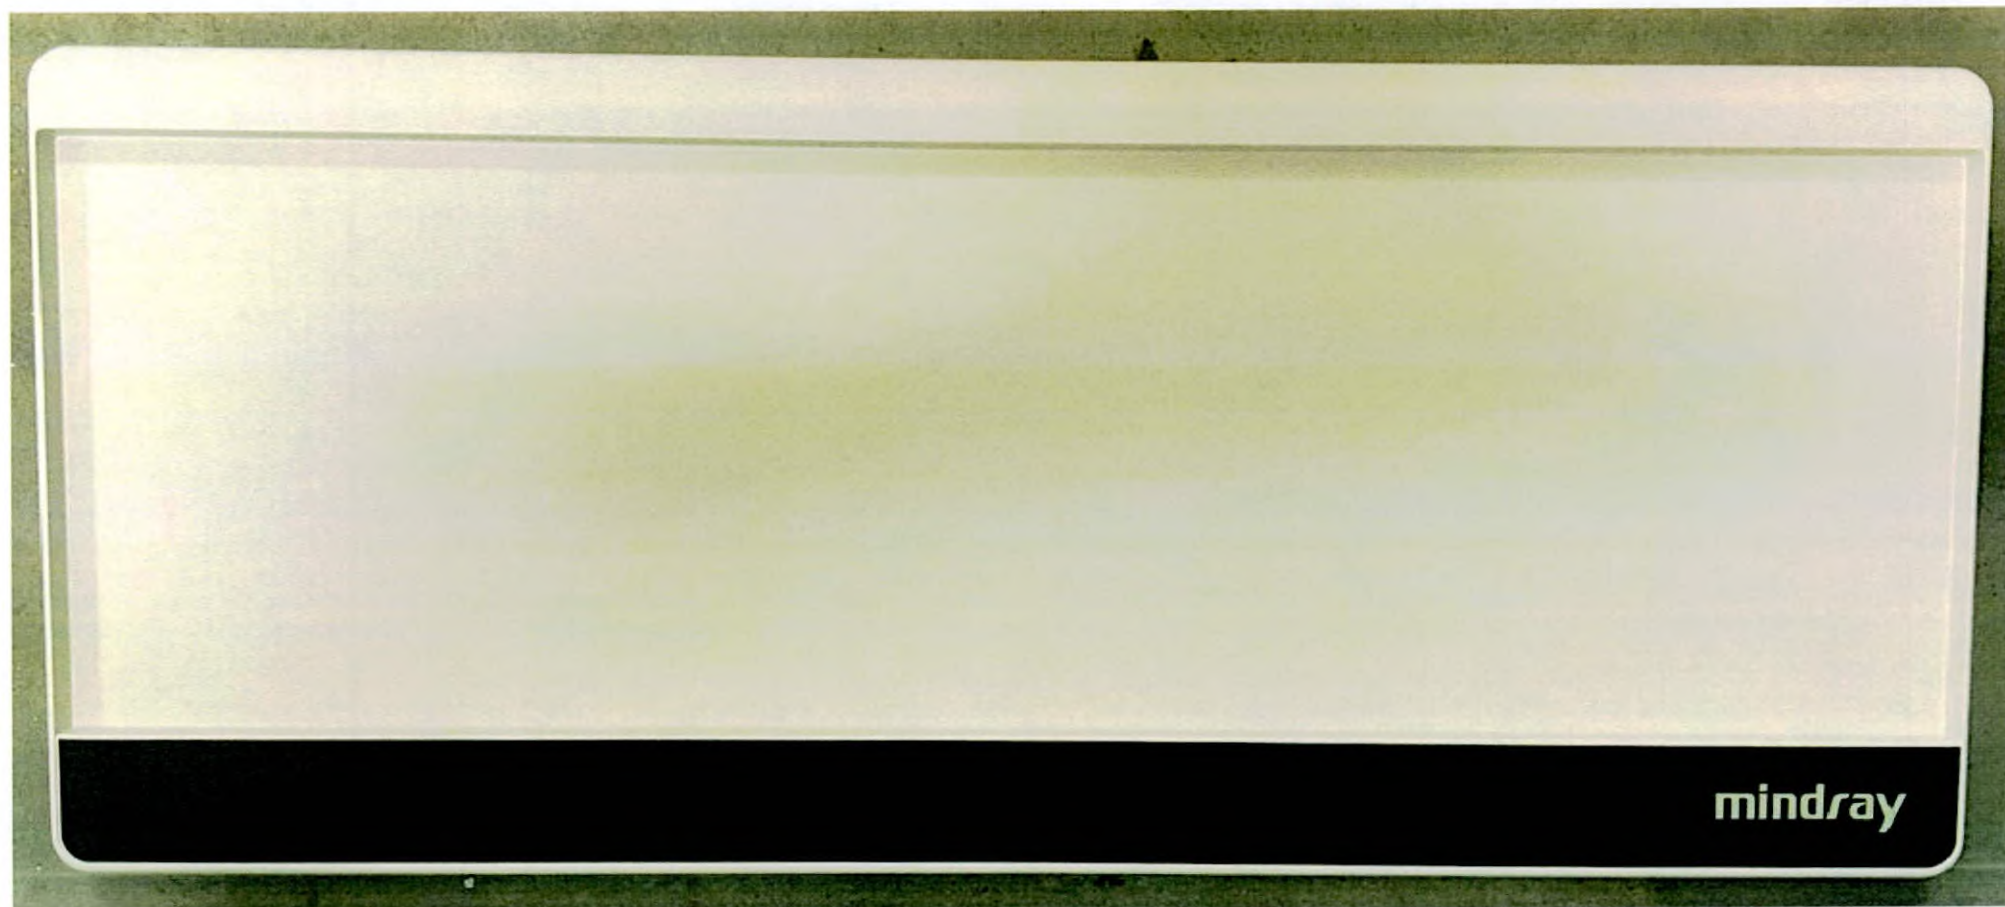


Держатель штативов

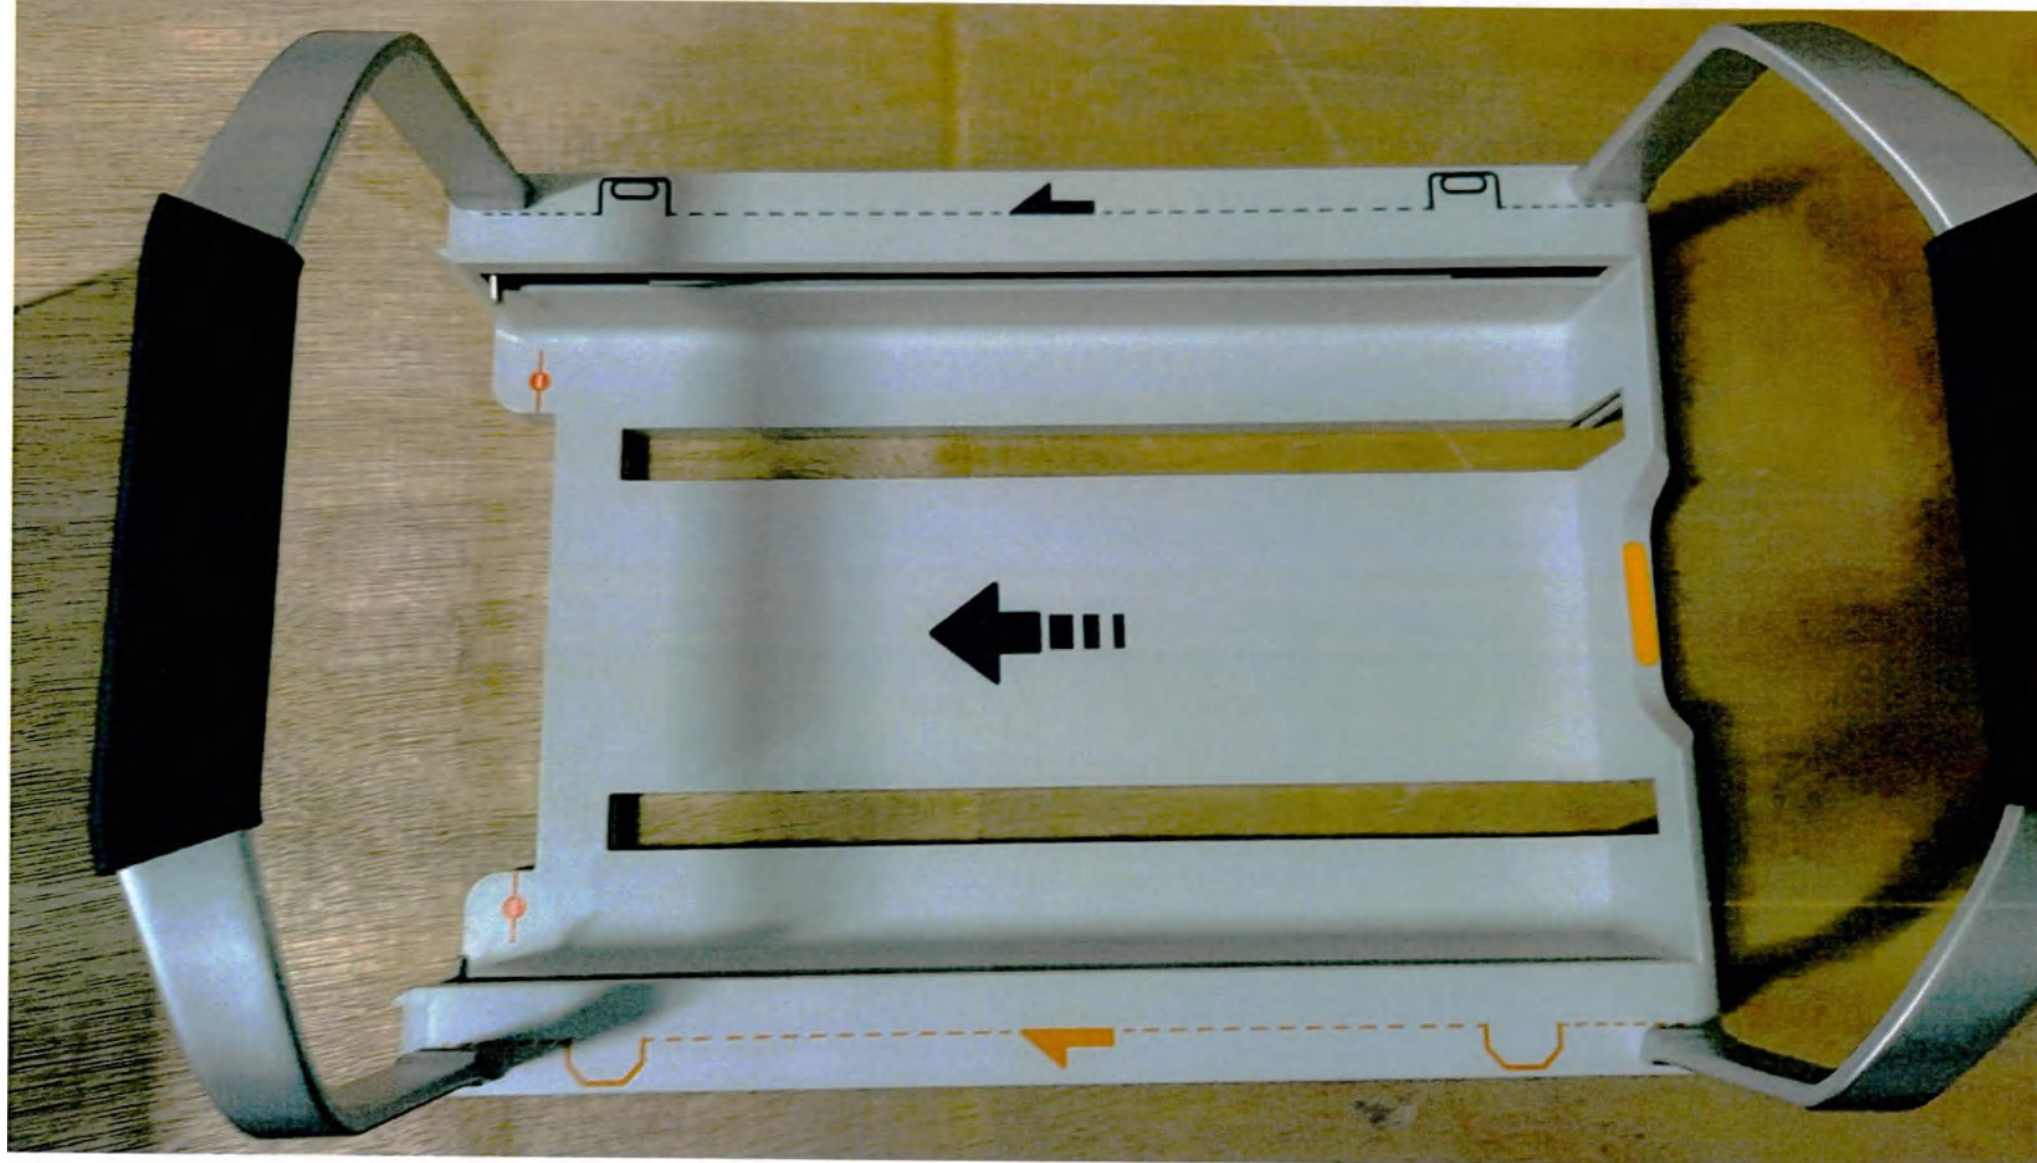


Сканер штрих-кодов внешний, в составе


Сканер штрих-кодов

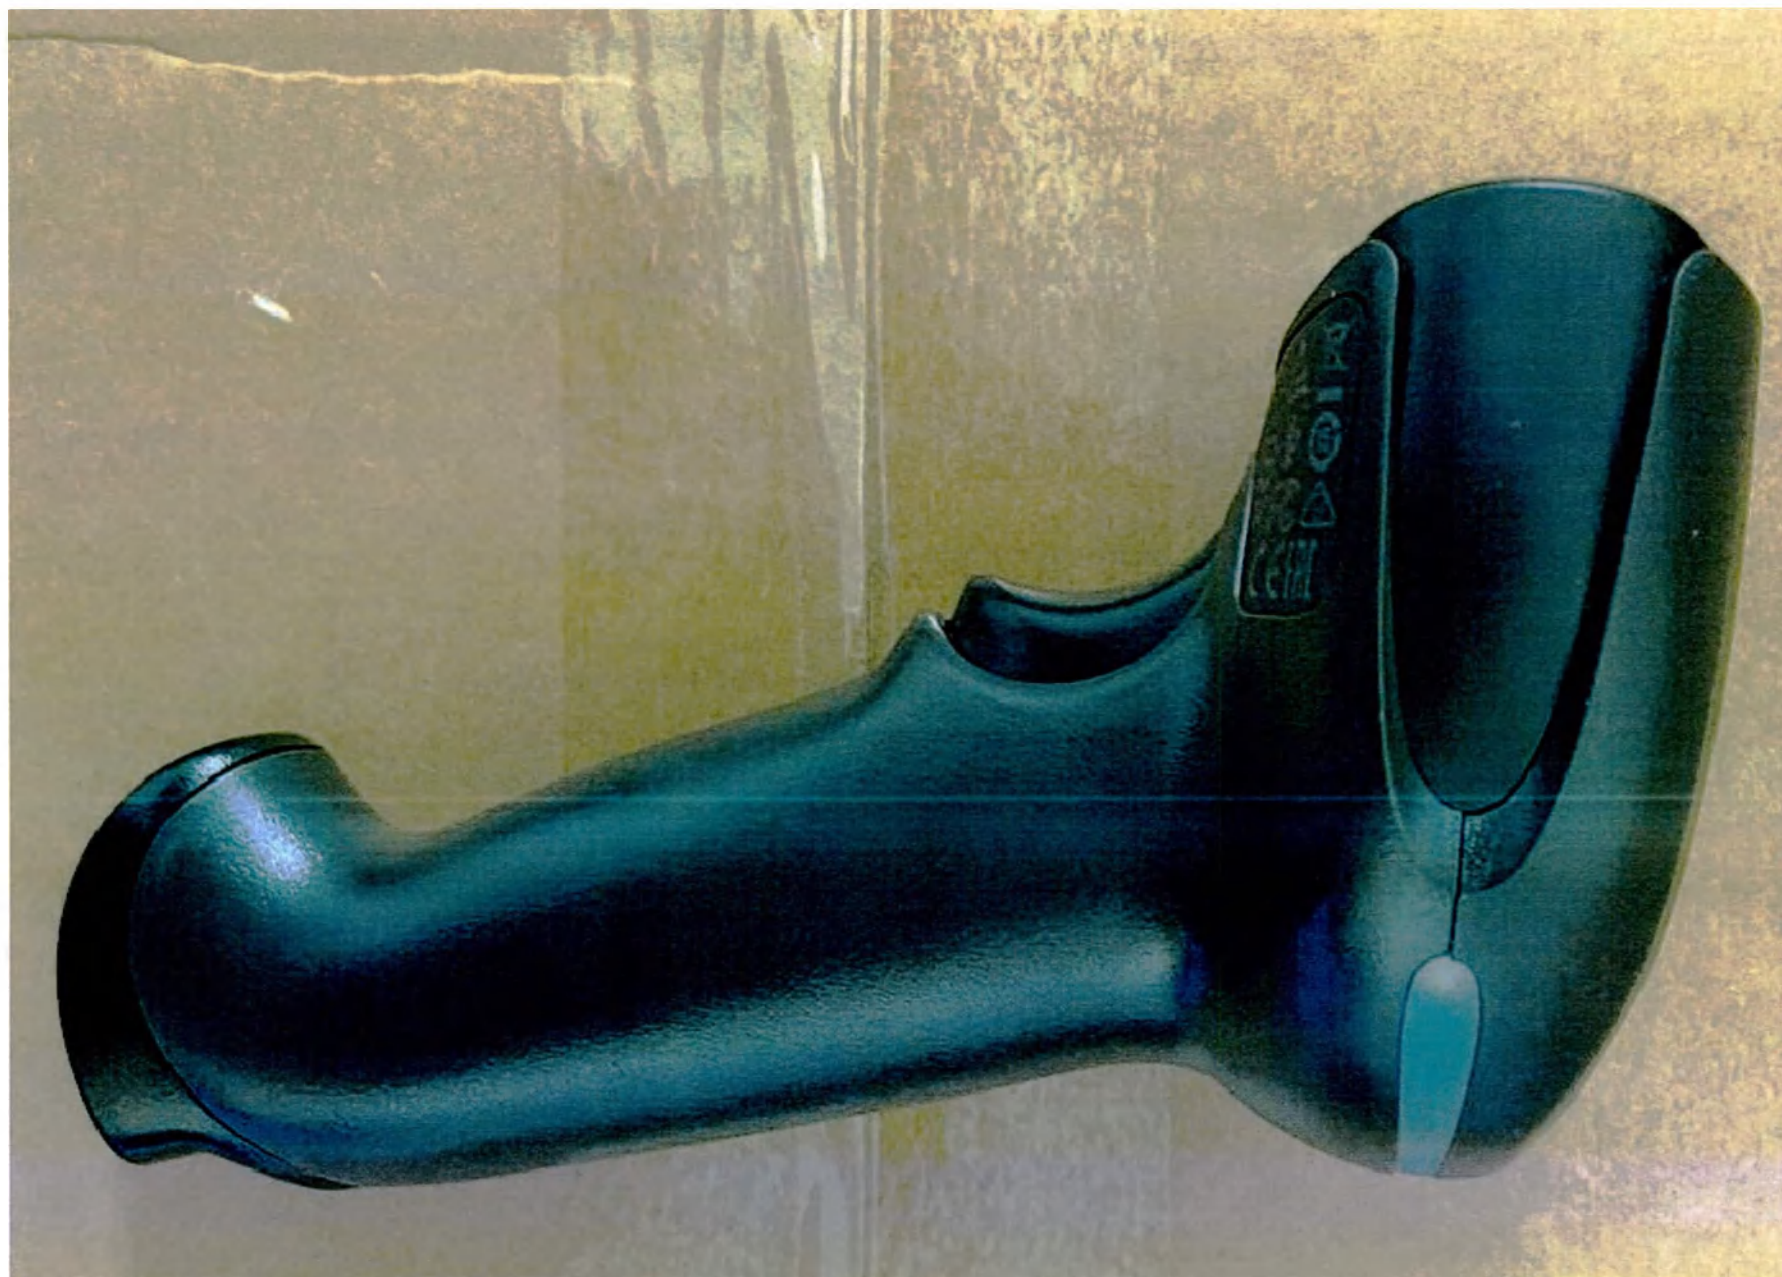


Кабель сканера

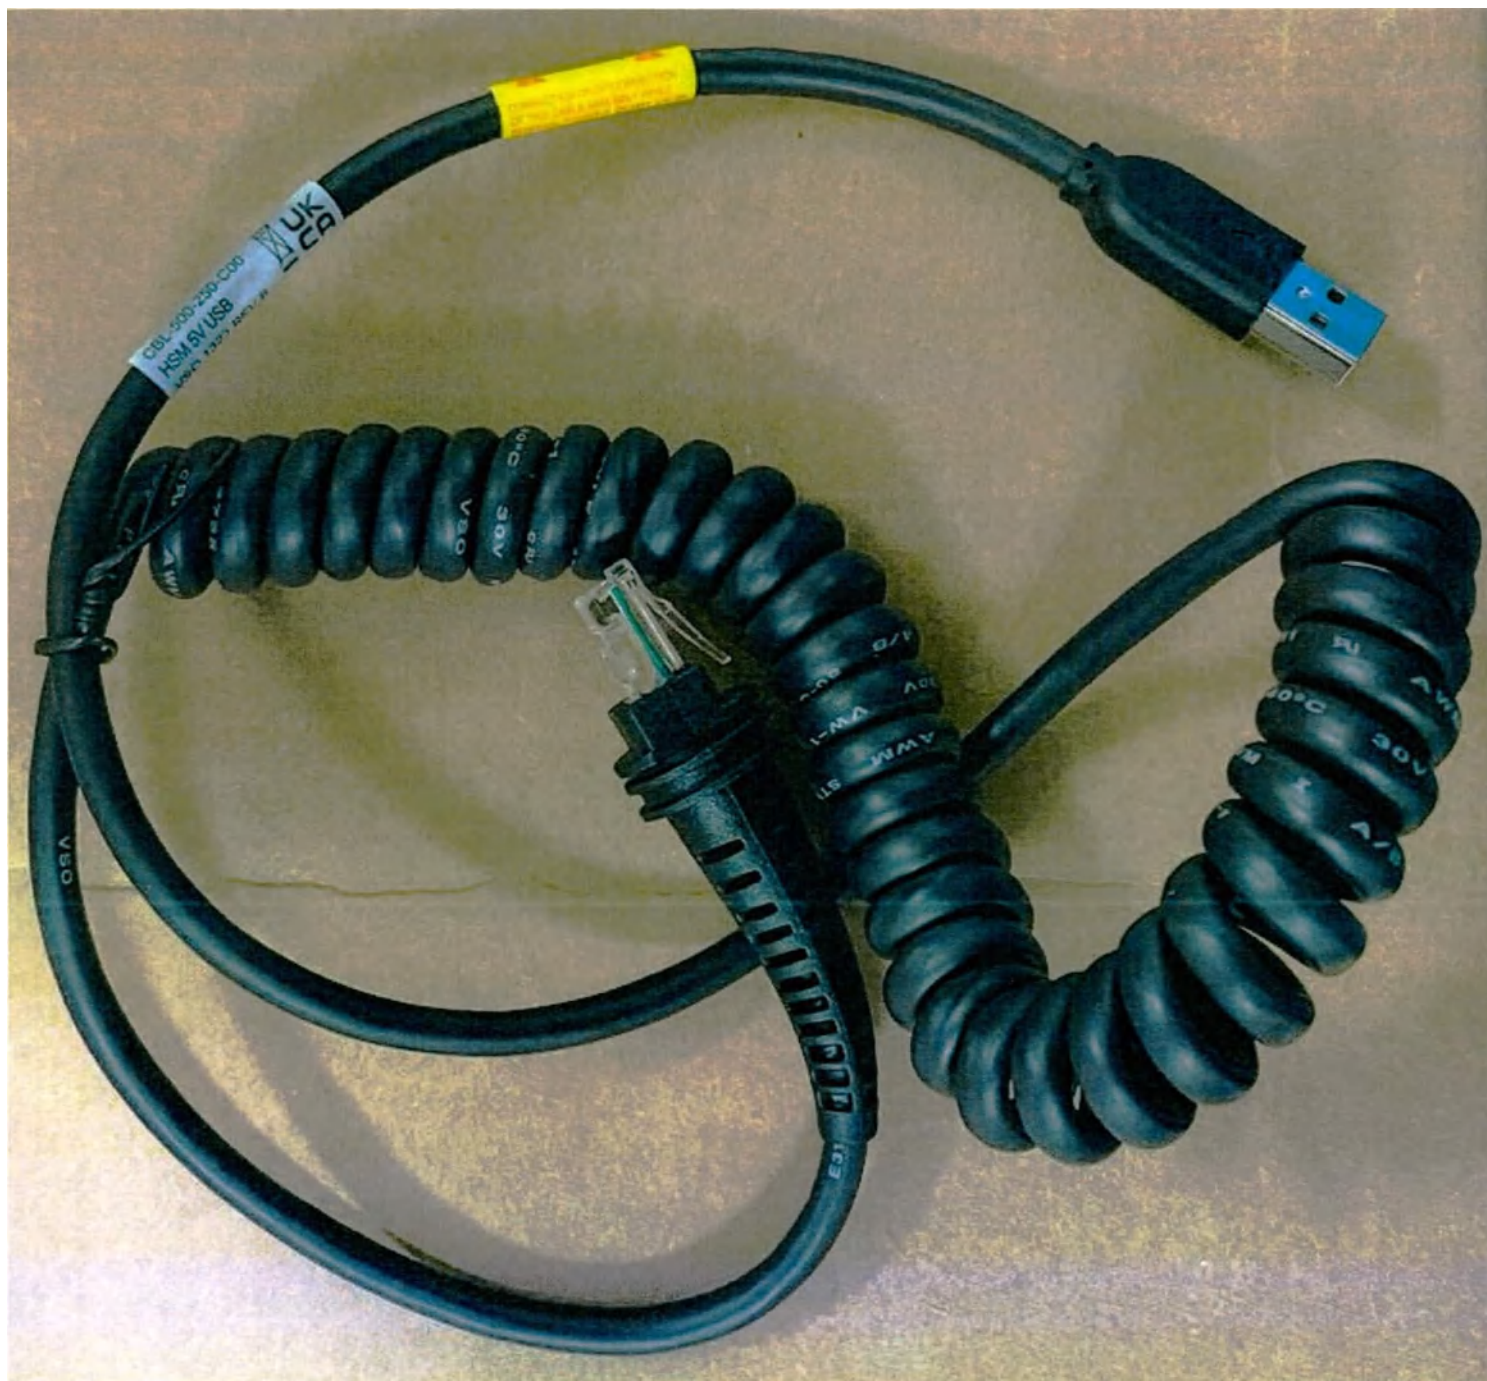


Подставка сканера штрих-кодов

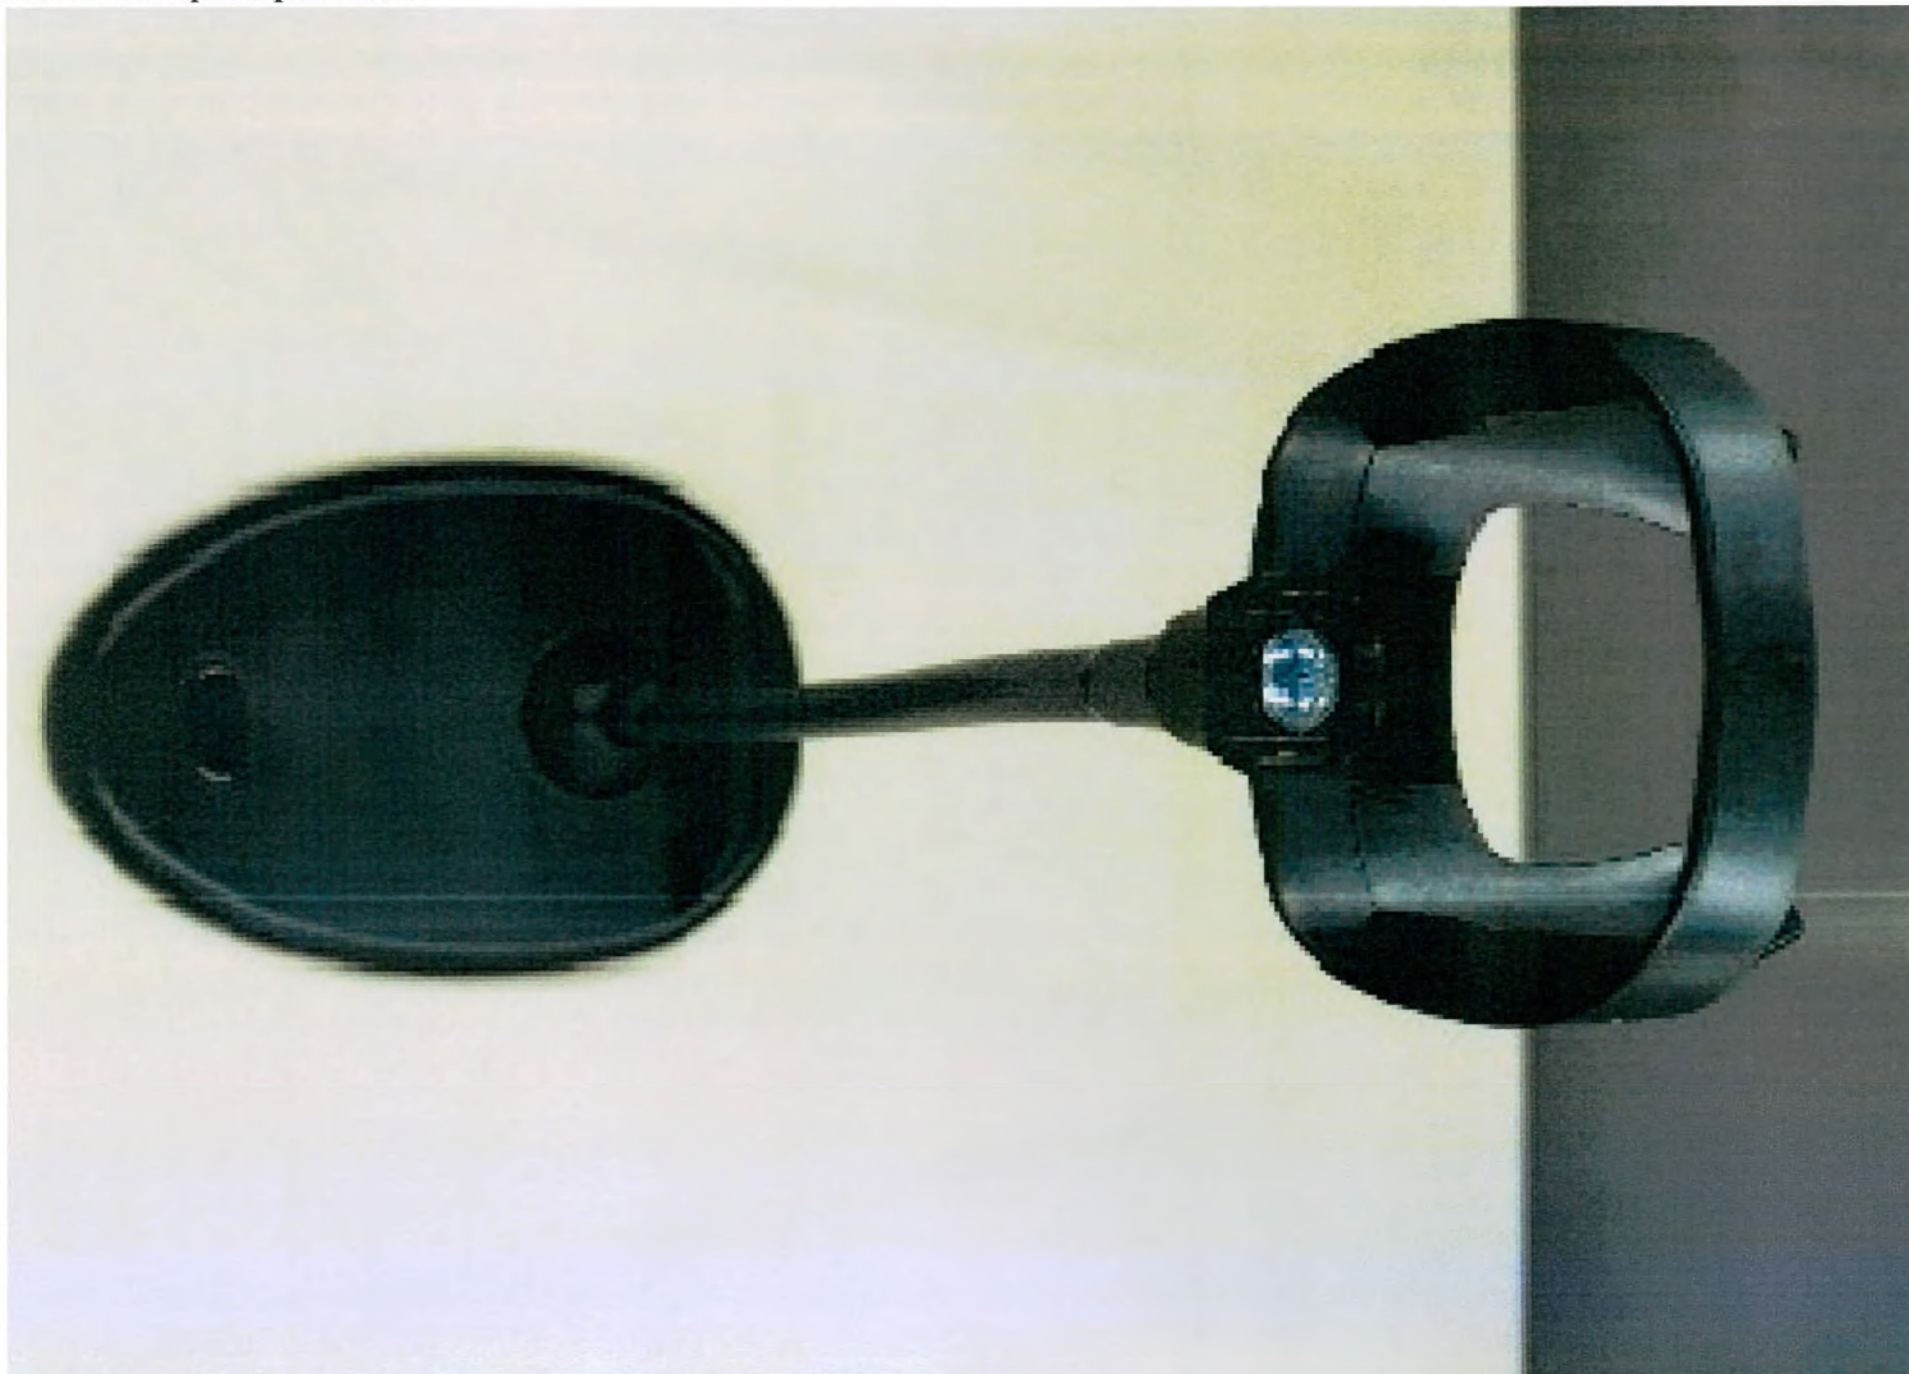


Держатель сканера штрих-кодов

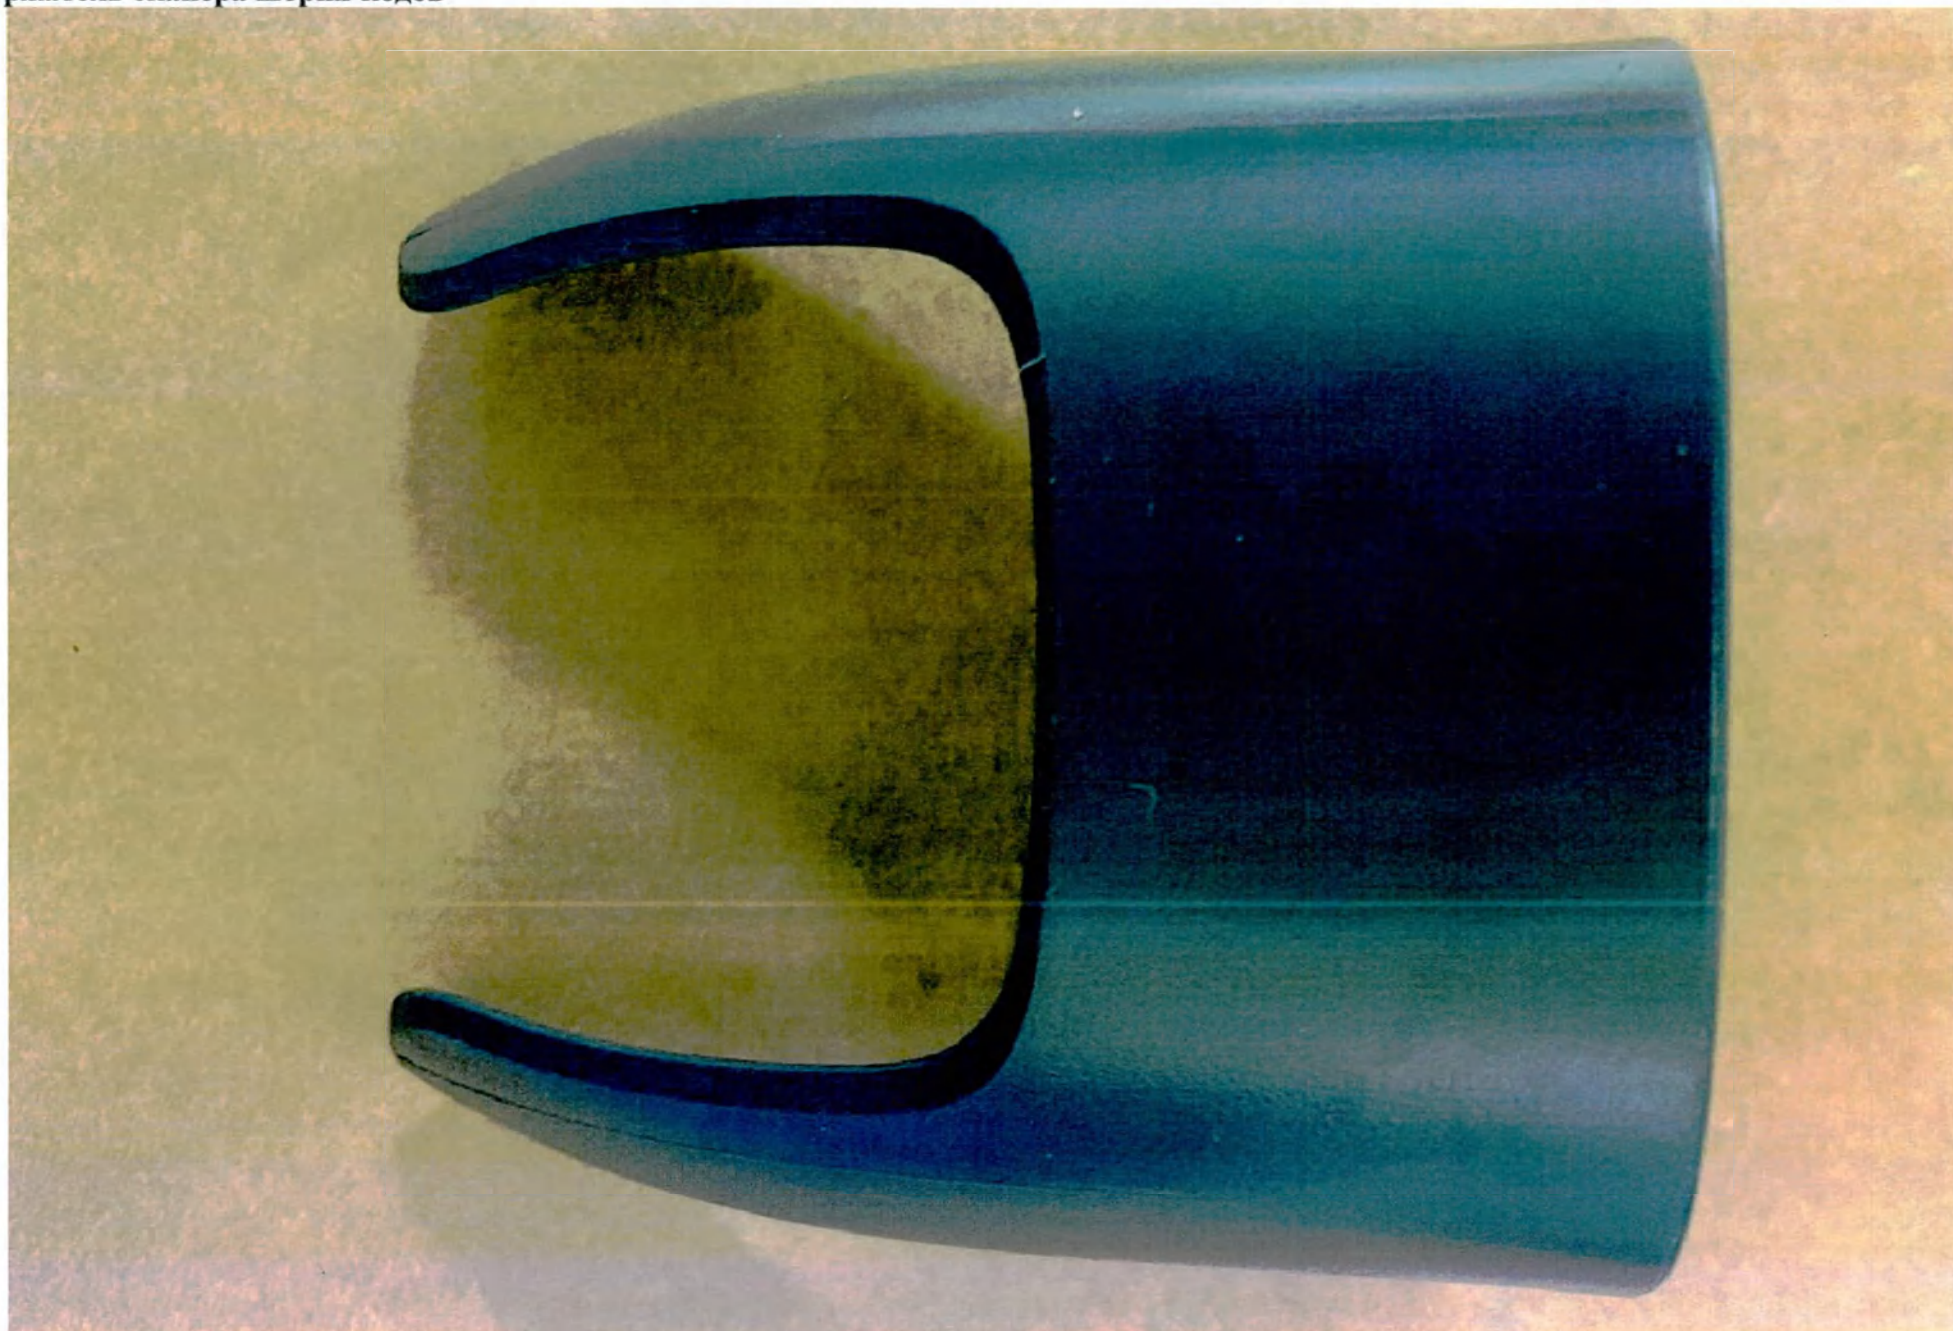

Держатель подставки сканера штрих-кодов

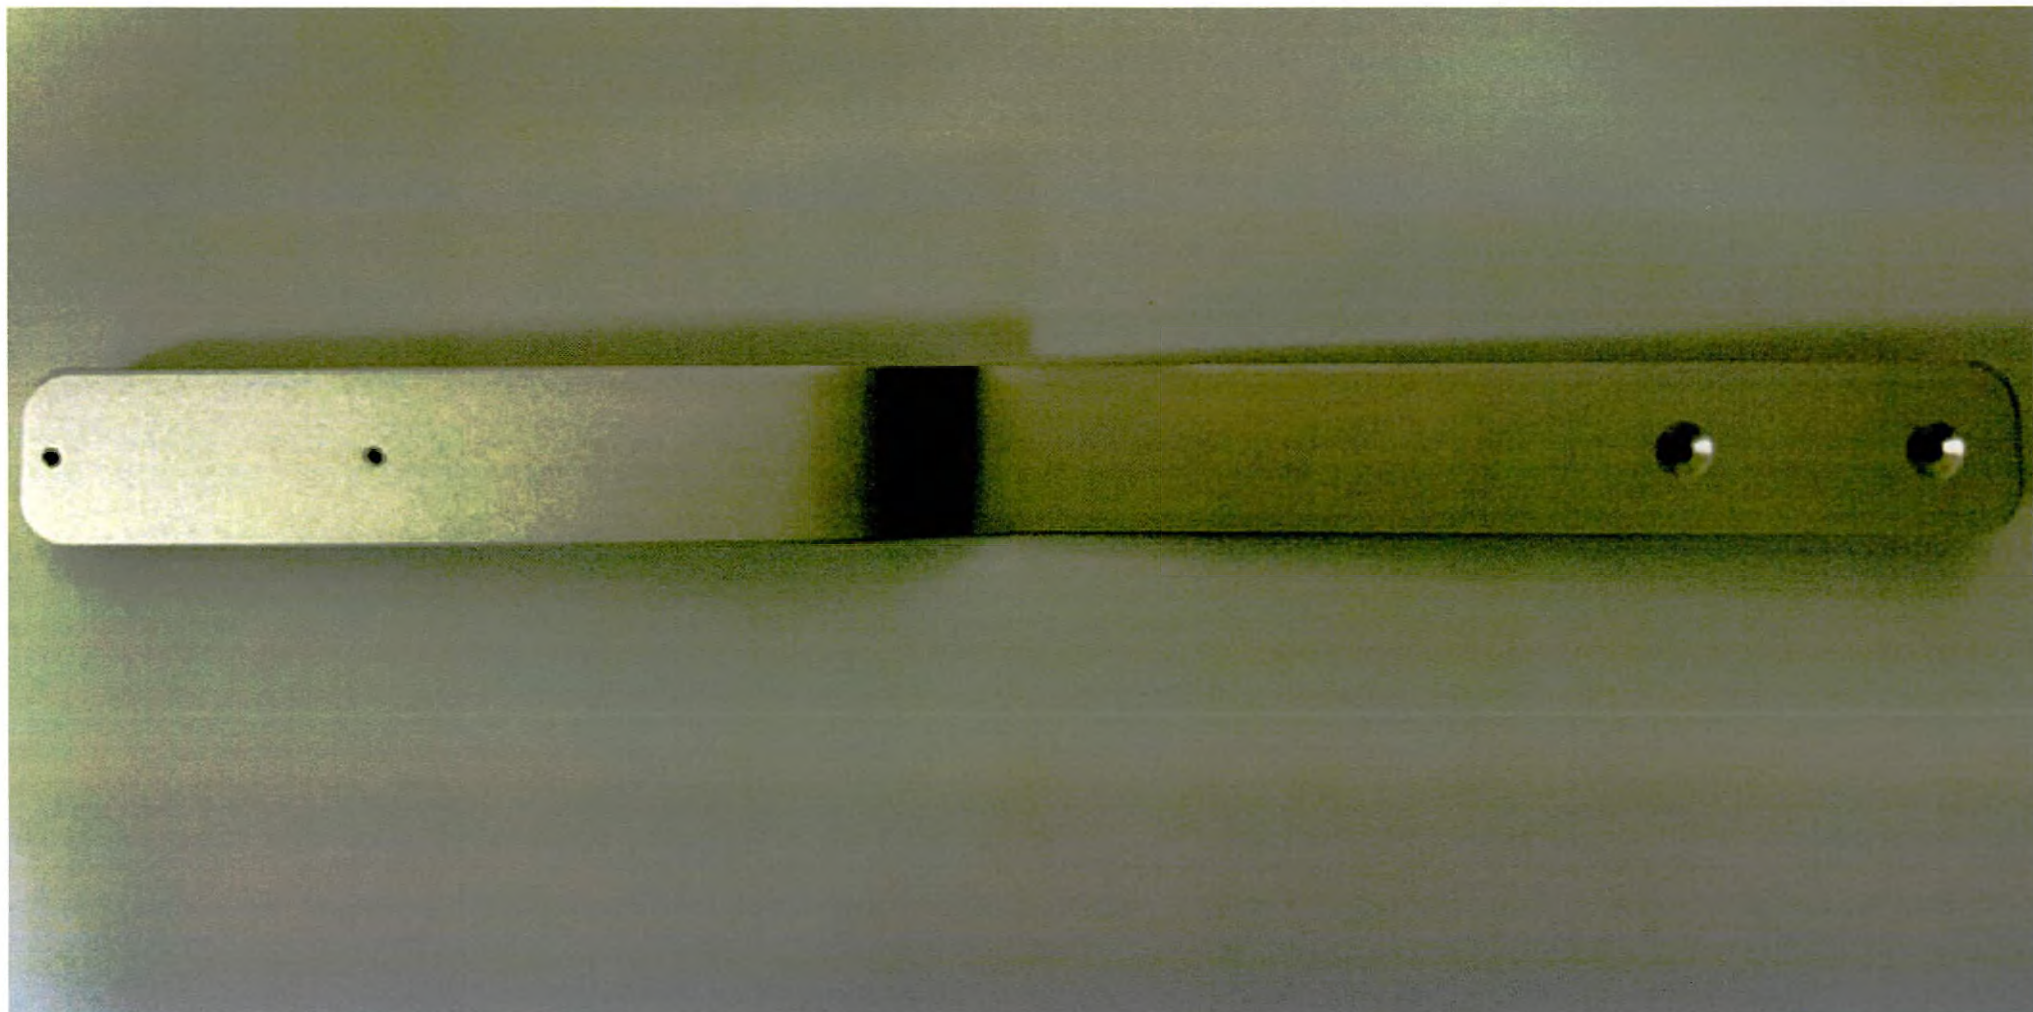

Внешний модуль подачи воды

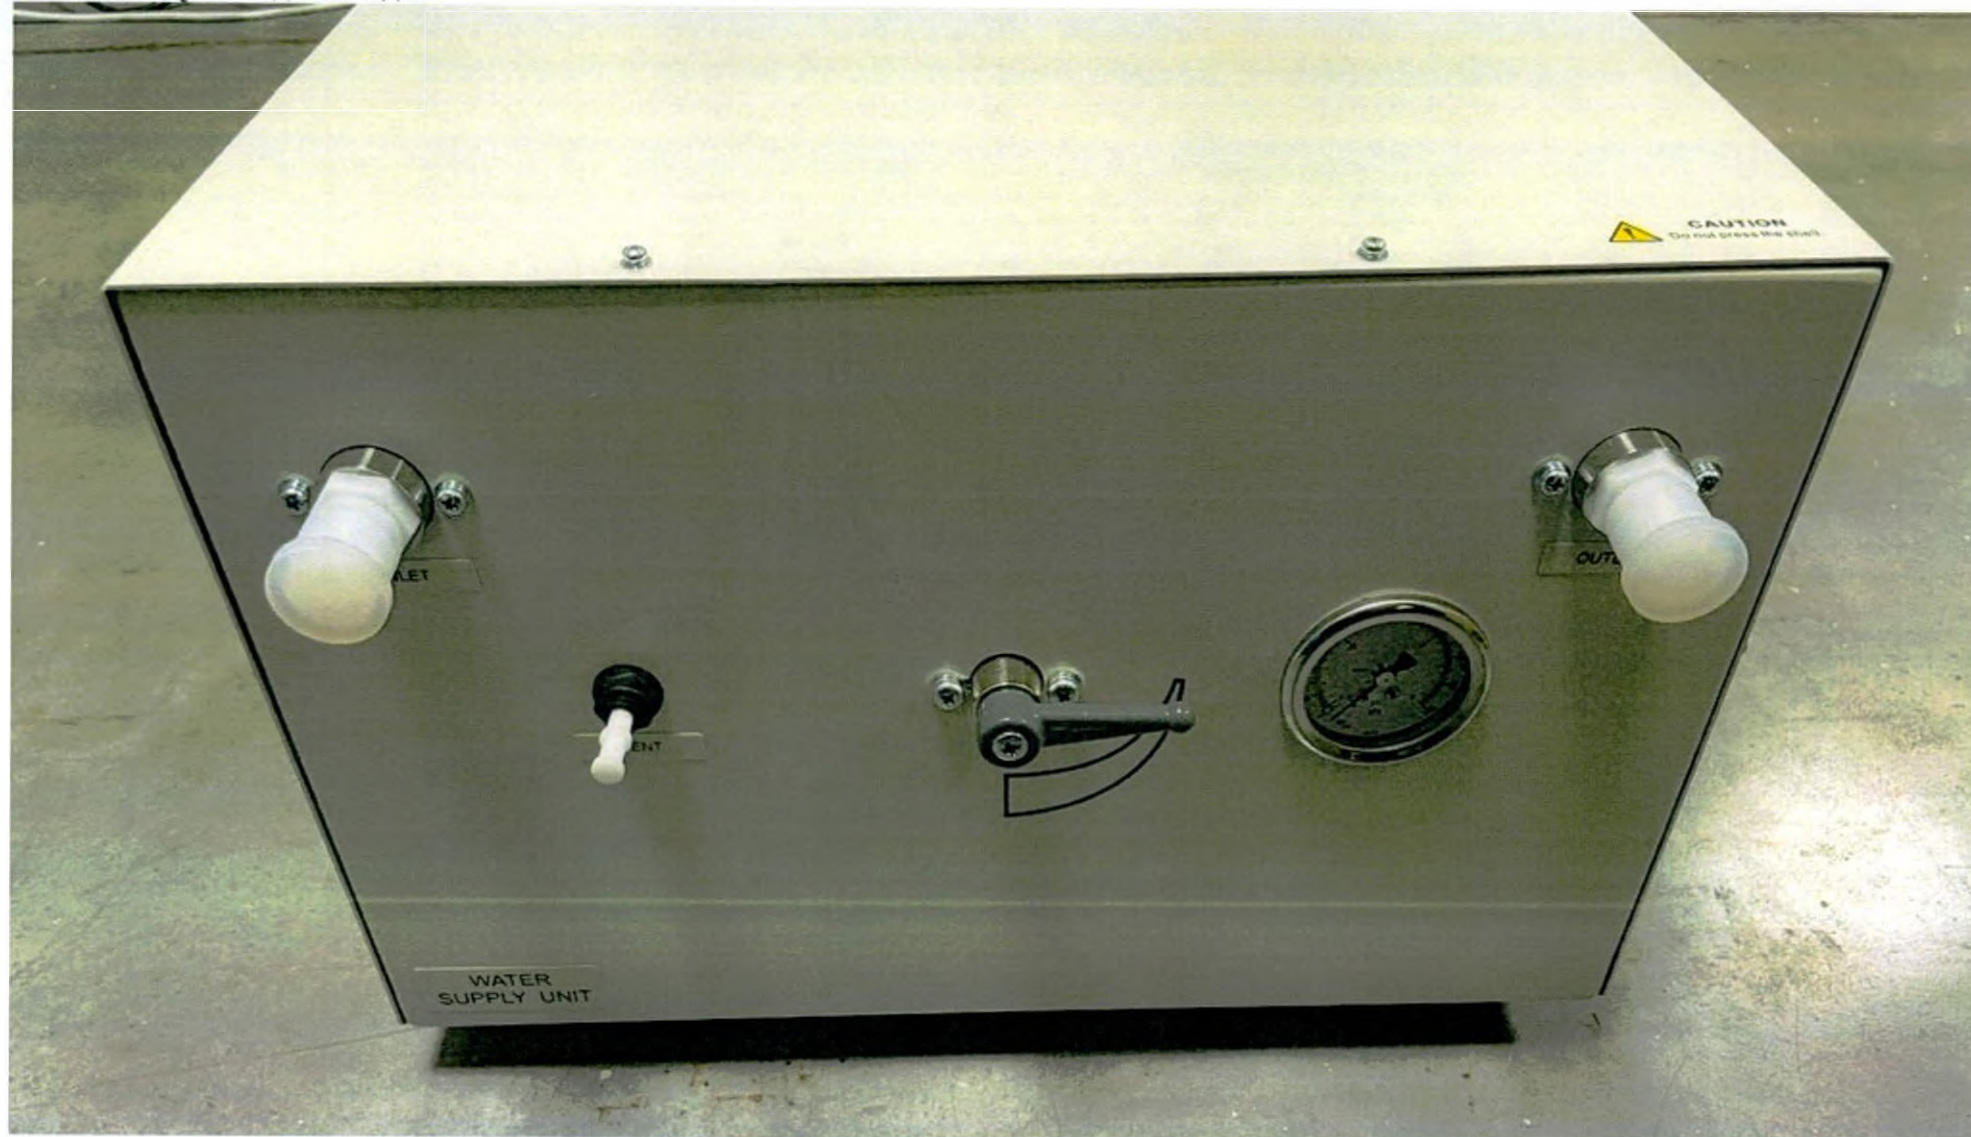


Маркировка, наносимая на корпус внешнего модуля подачи воды


mindray

Water Supply Module

SN



XEA39002097



2023-09-06

100-240V ~ 50/60Hz 100VA



047-002805-00(5.0)

Made In China



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Компрессор воздушный внешний



mindray

External Vacuum Pump

SN




XEB39002098



2023-09-06

220-240V ~ 50Hz 500VA

220/230V ~ 60Hz 500VA




047-021897-00(20)

Made In China



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Кварцевая реакционная кювета




Емкость сливная




Флаккон для воды

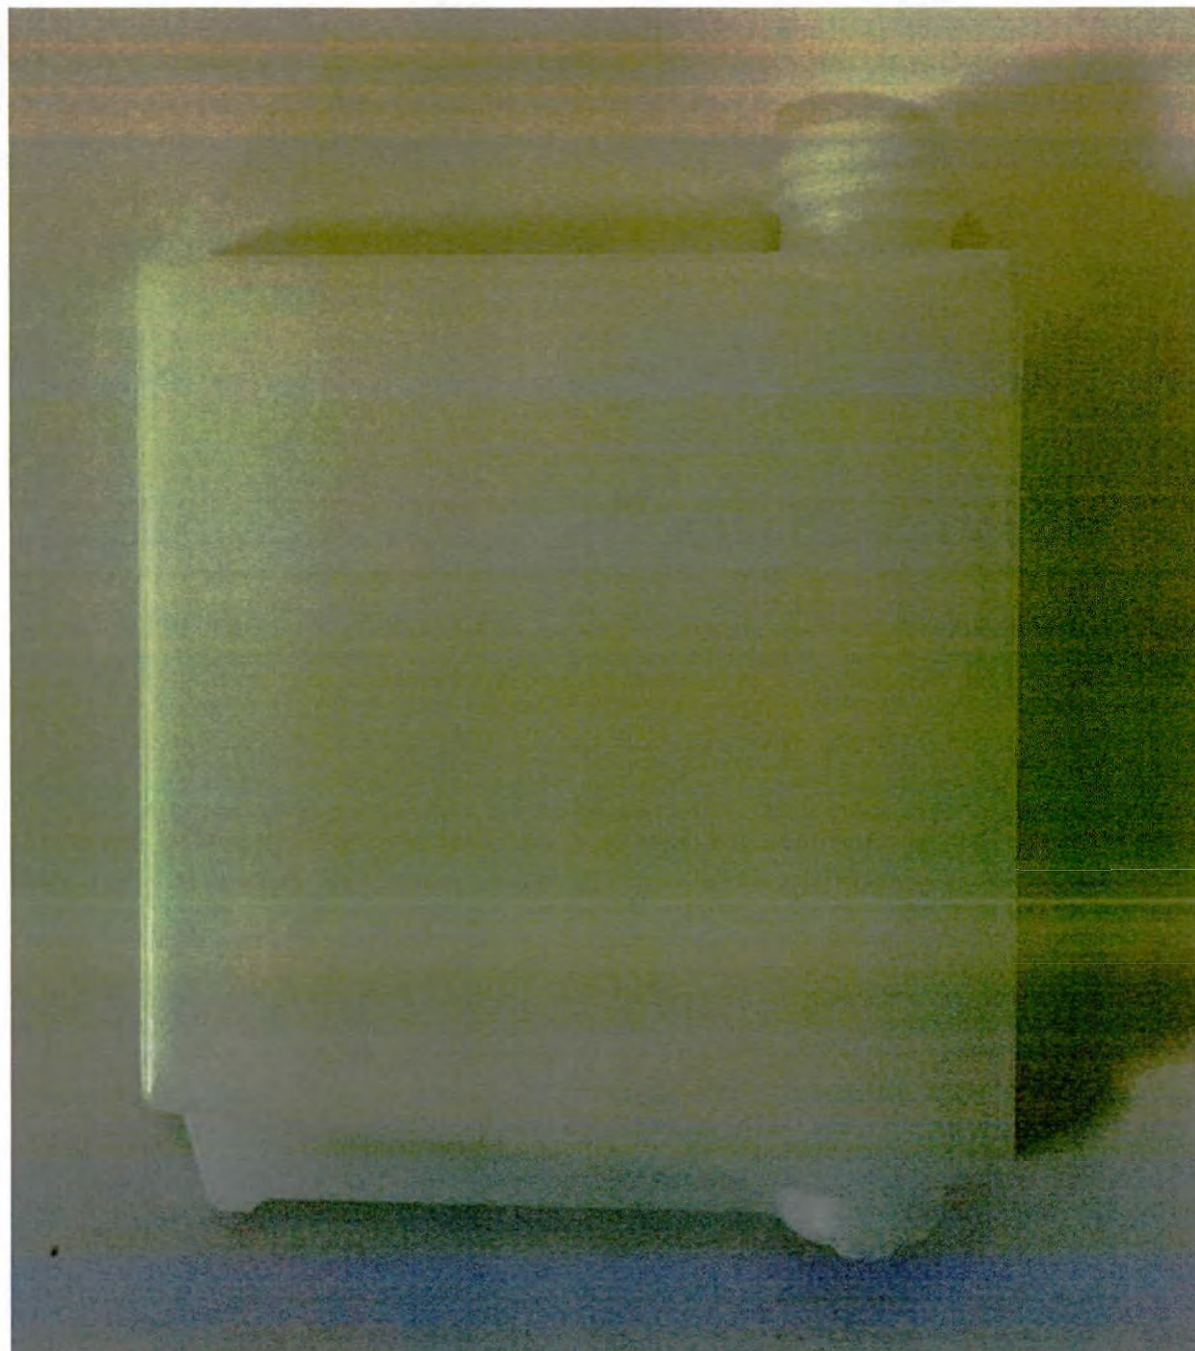


Флакон для реагента, 20 мл

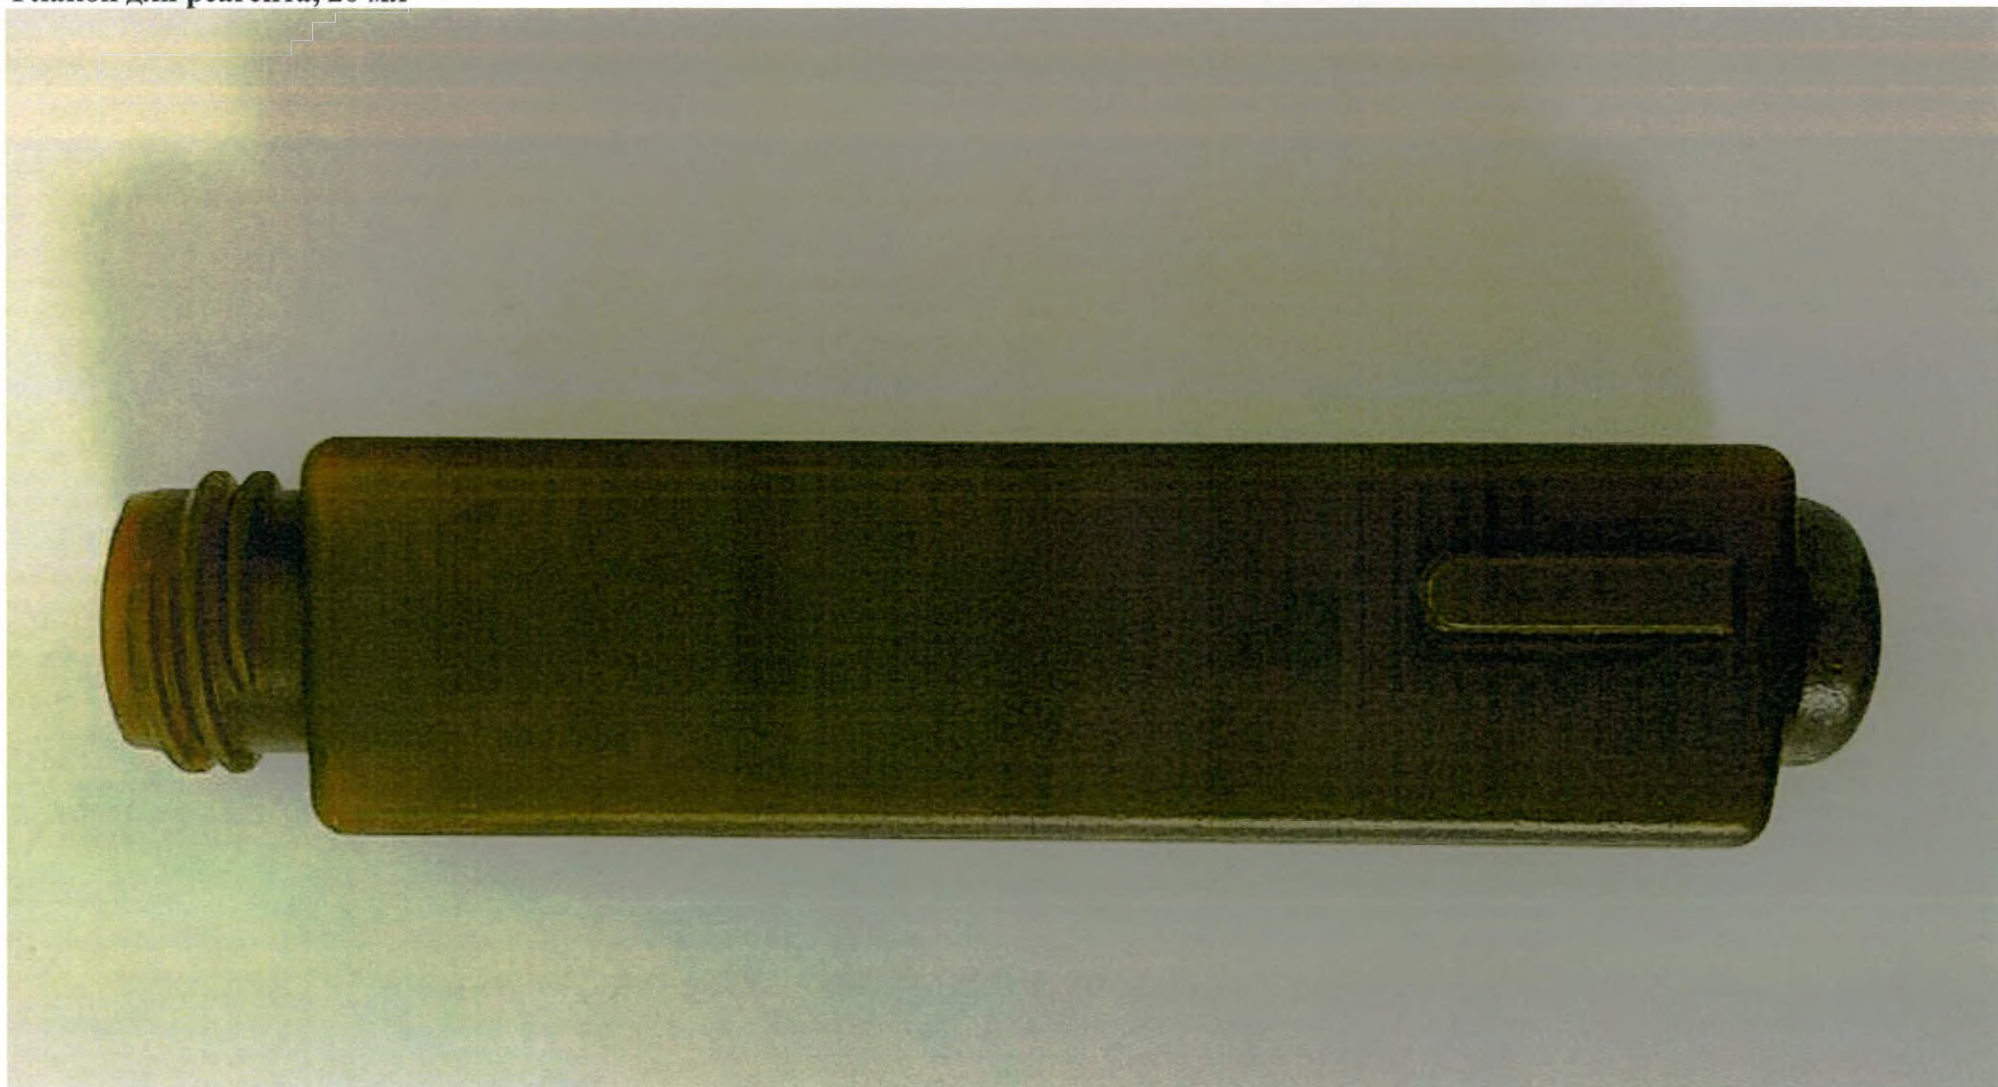

Флакон для реагента, 62 мл

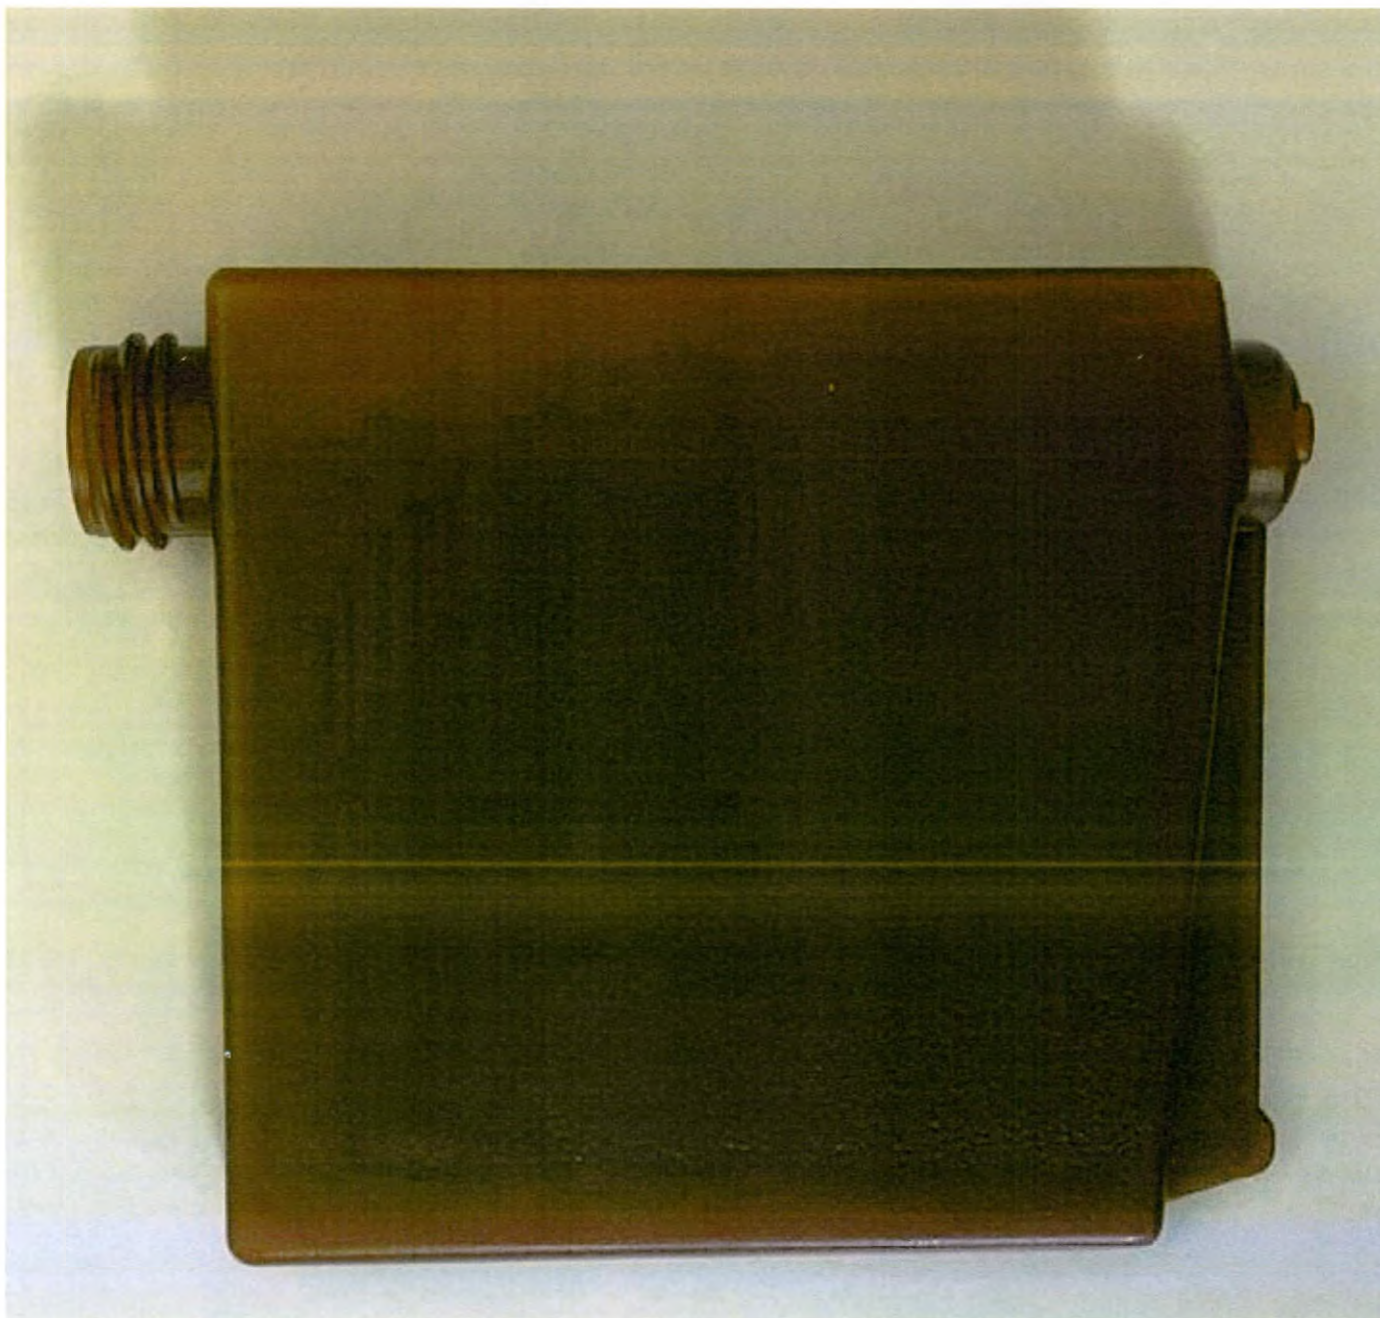


Крышка для емкости сливной в сборе

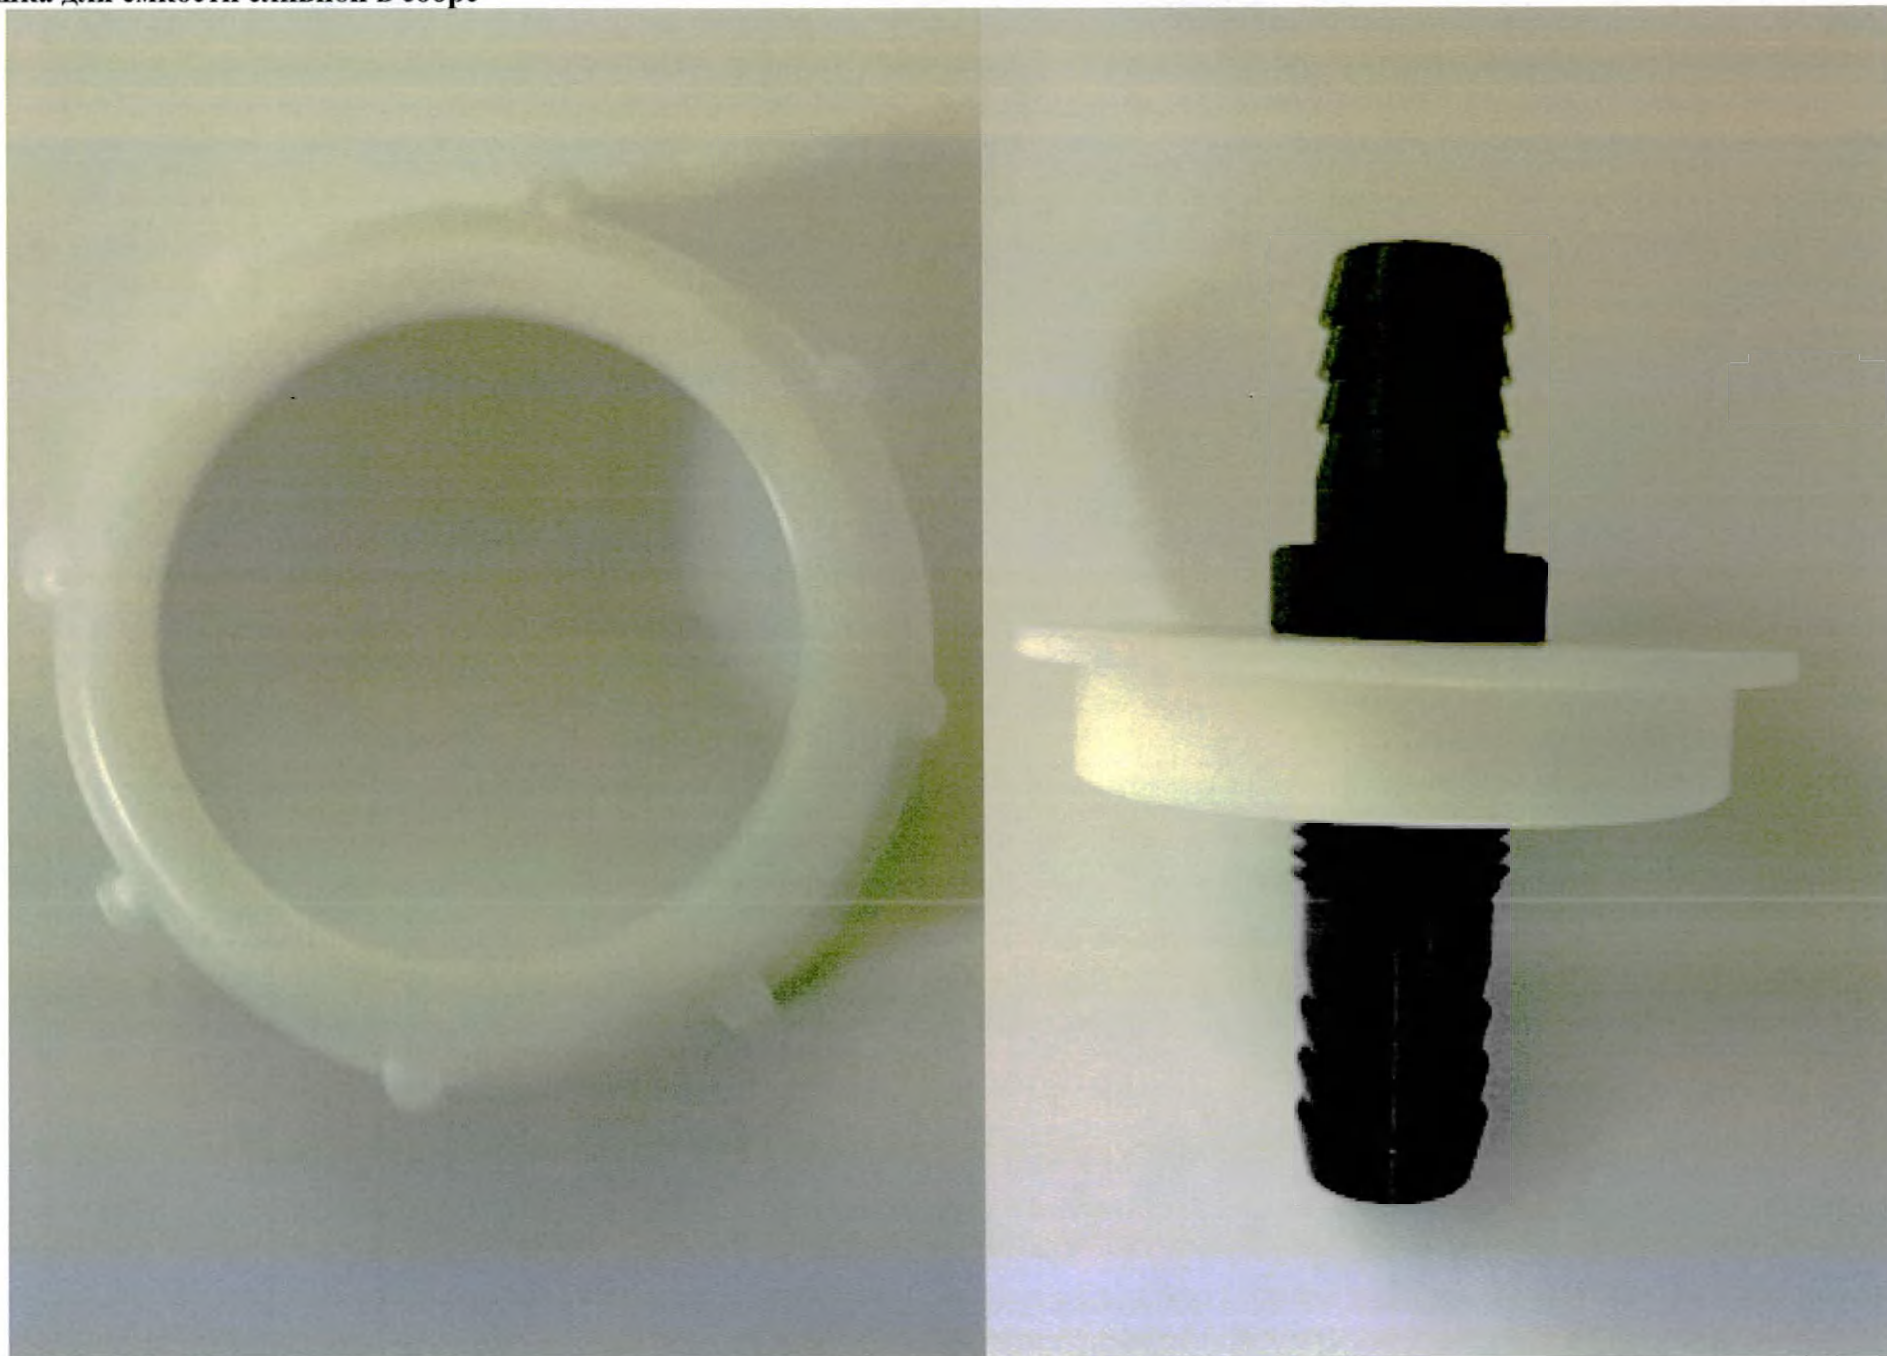


Крышка для емкости сливной с детектором уровня жидкости в сборе




Крышка для флакона для реагента, красная

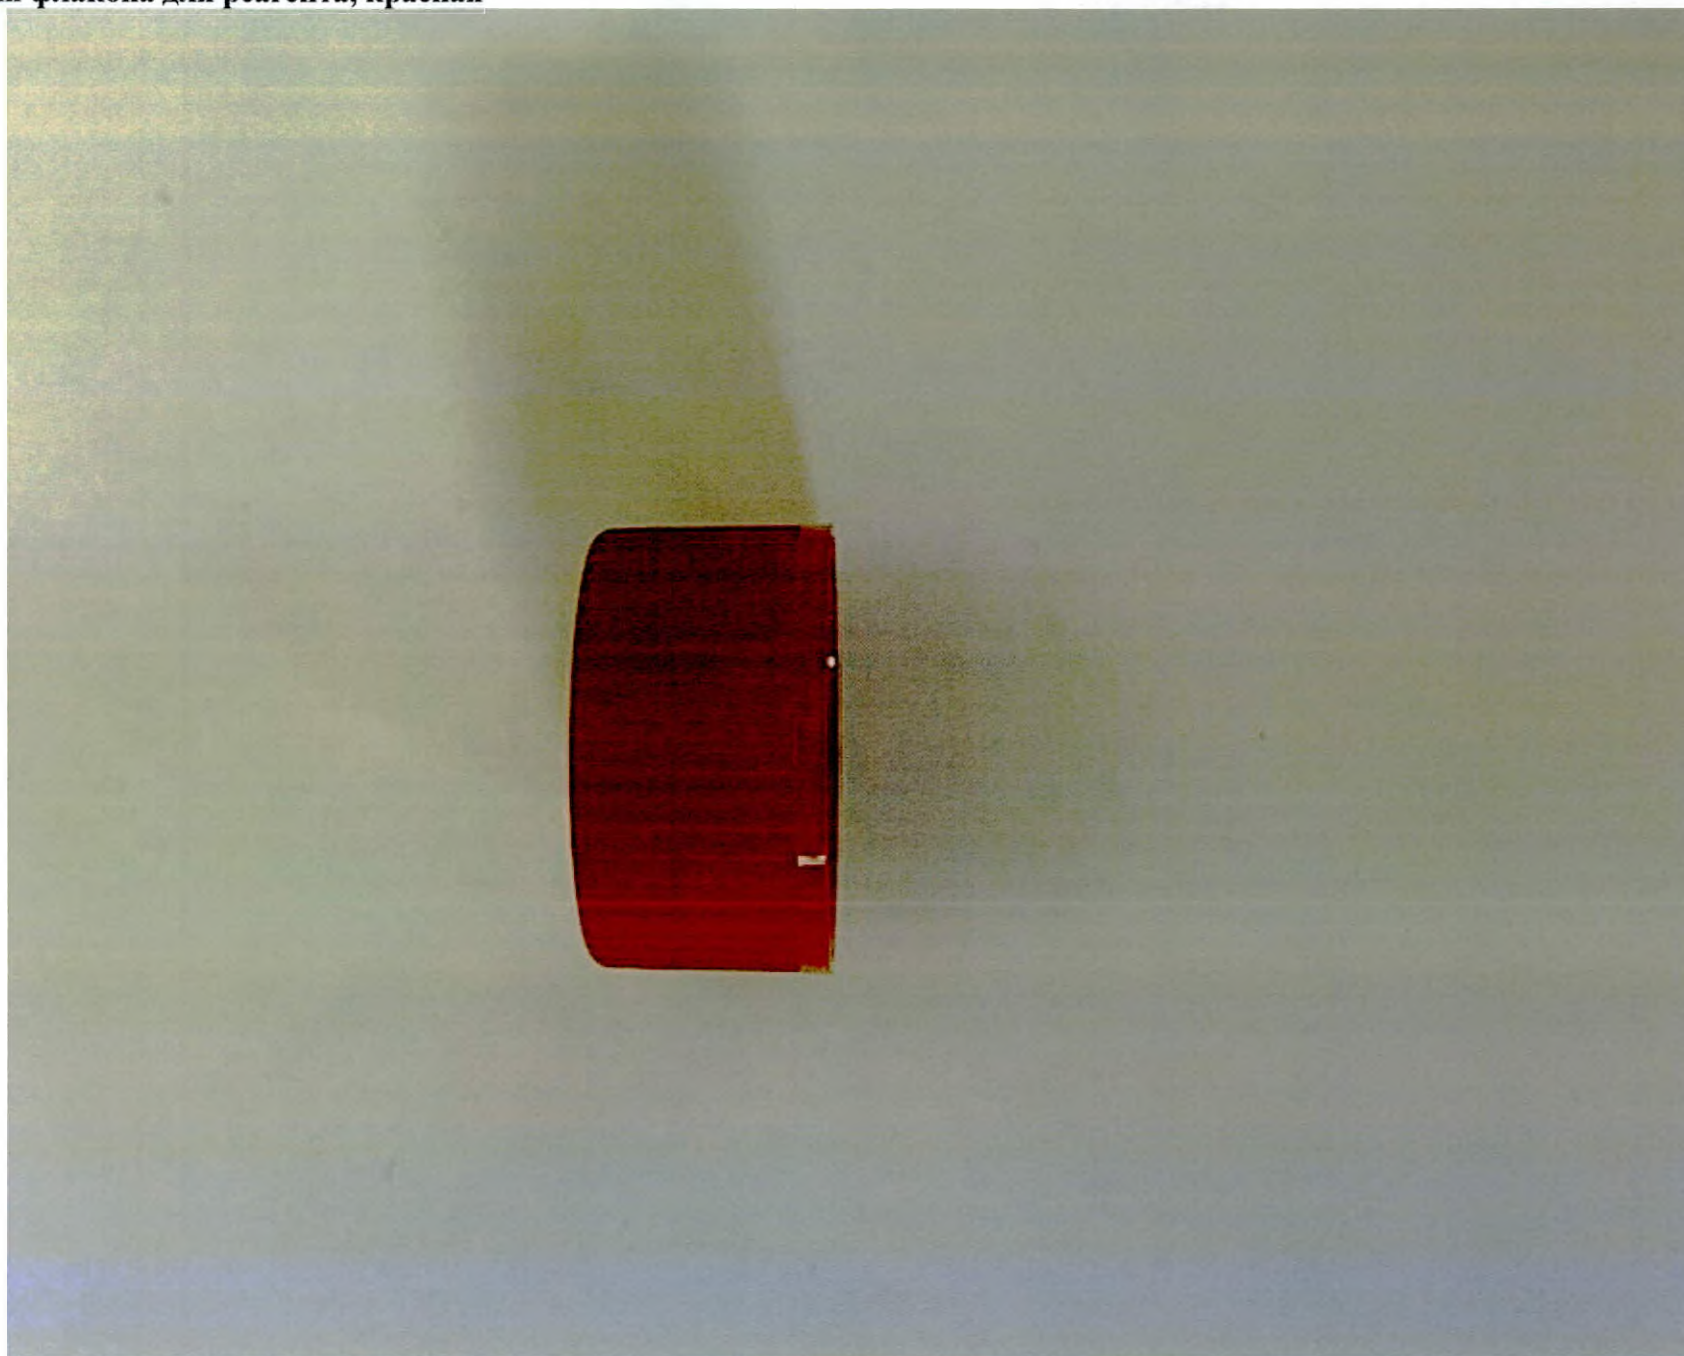


Крышка для флакона для реагента, белая

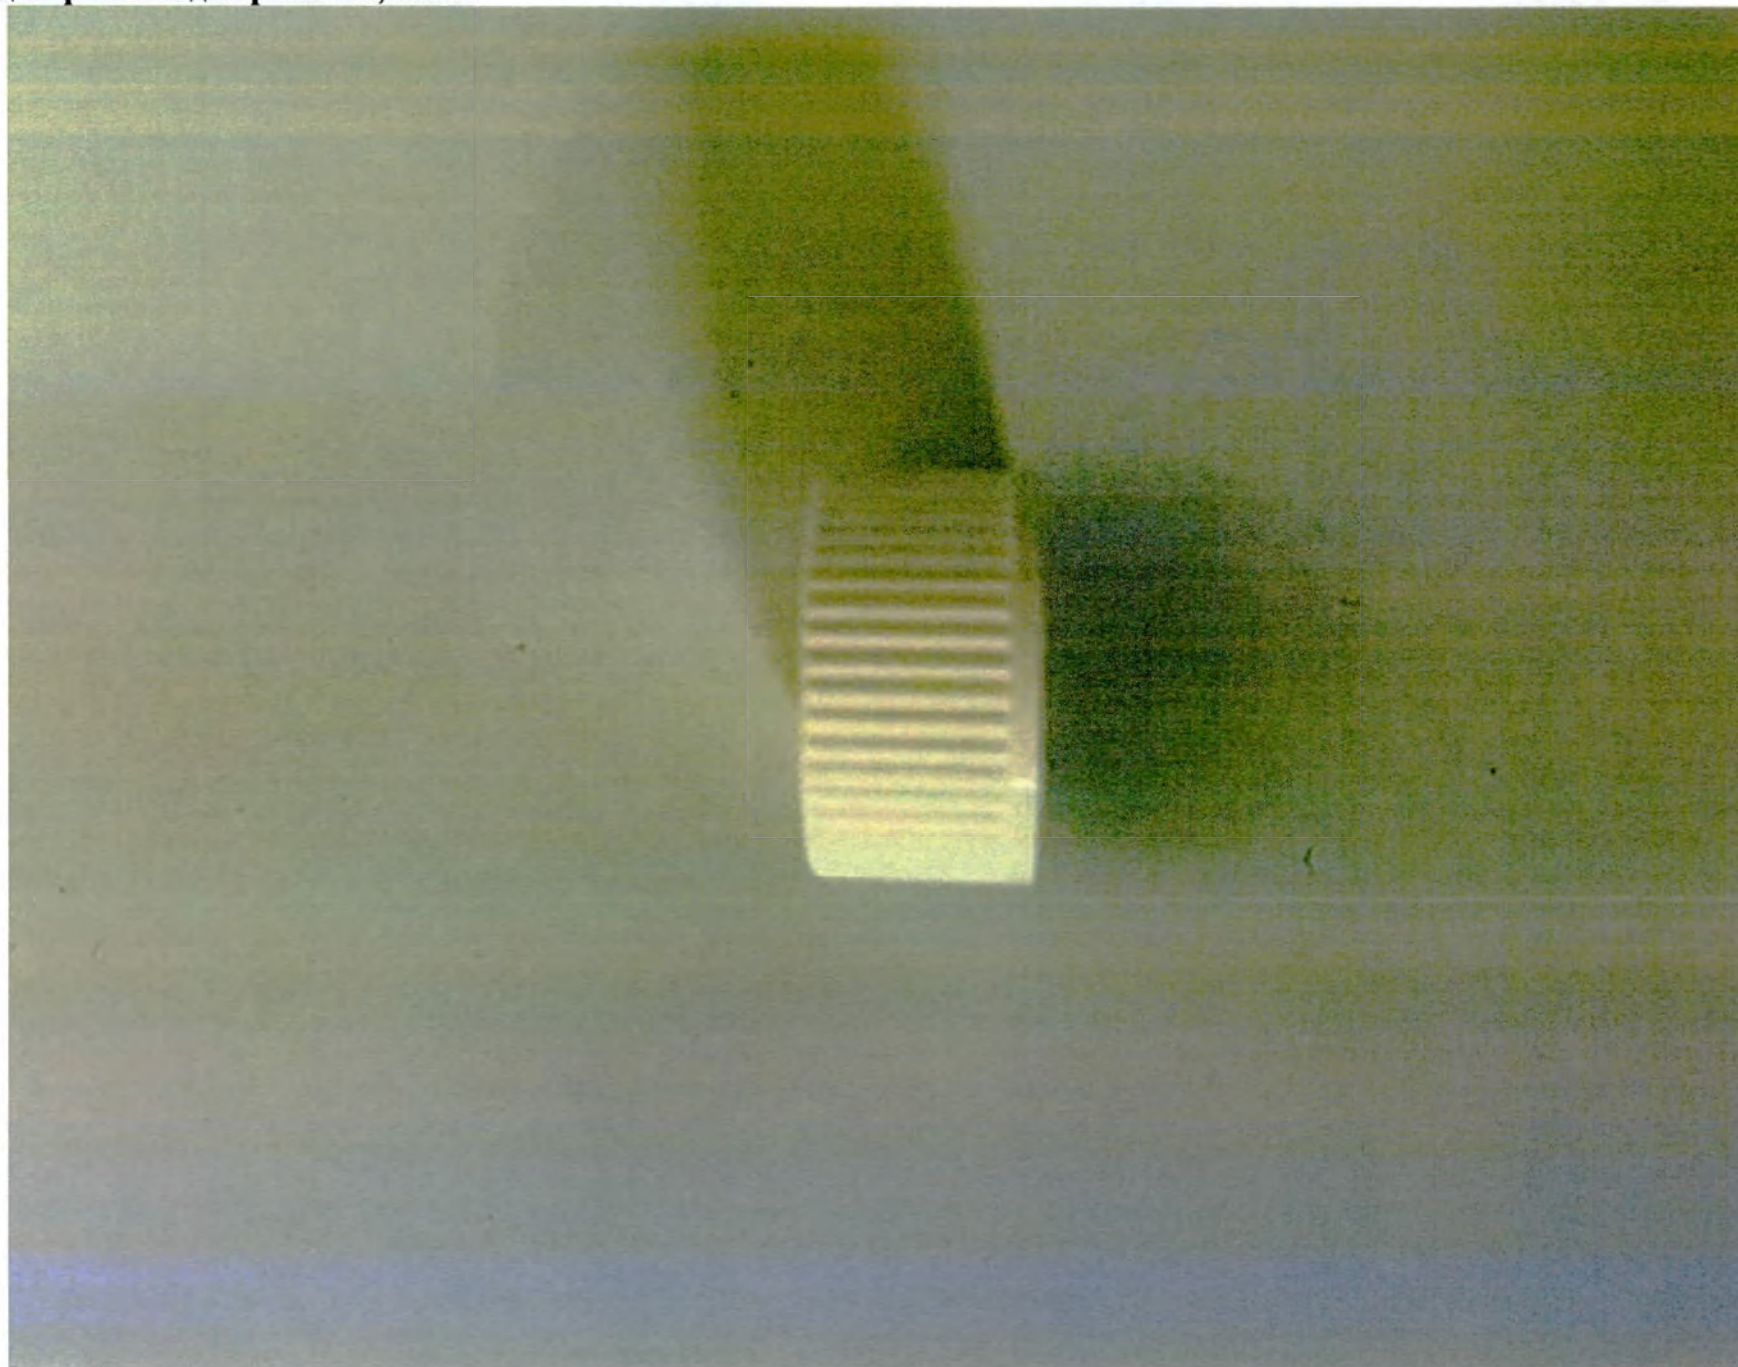


Пробирки для образцов, 2,0 мл

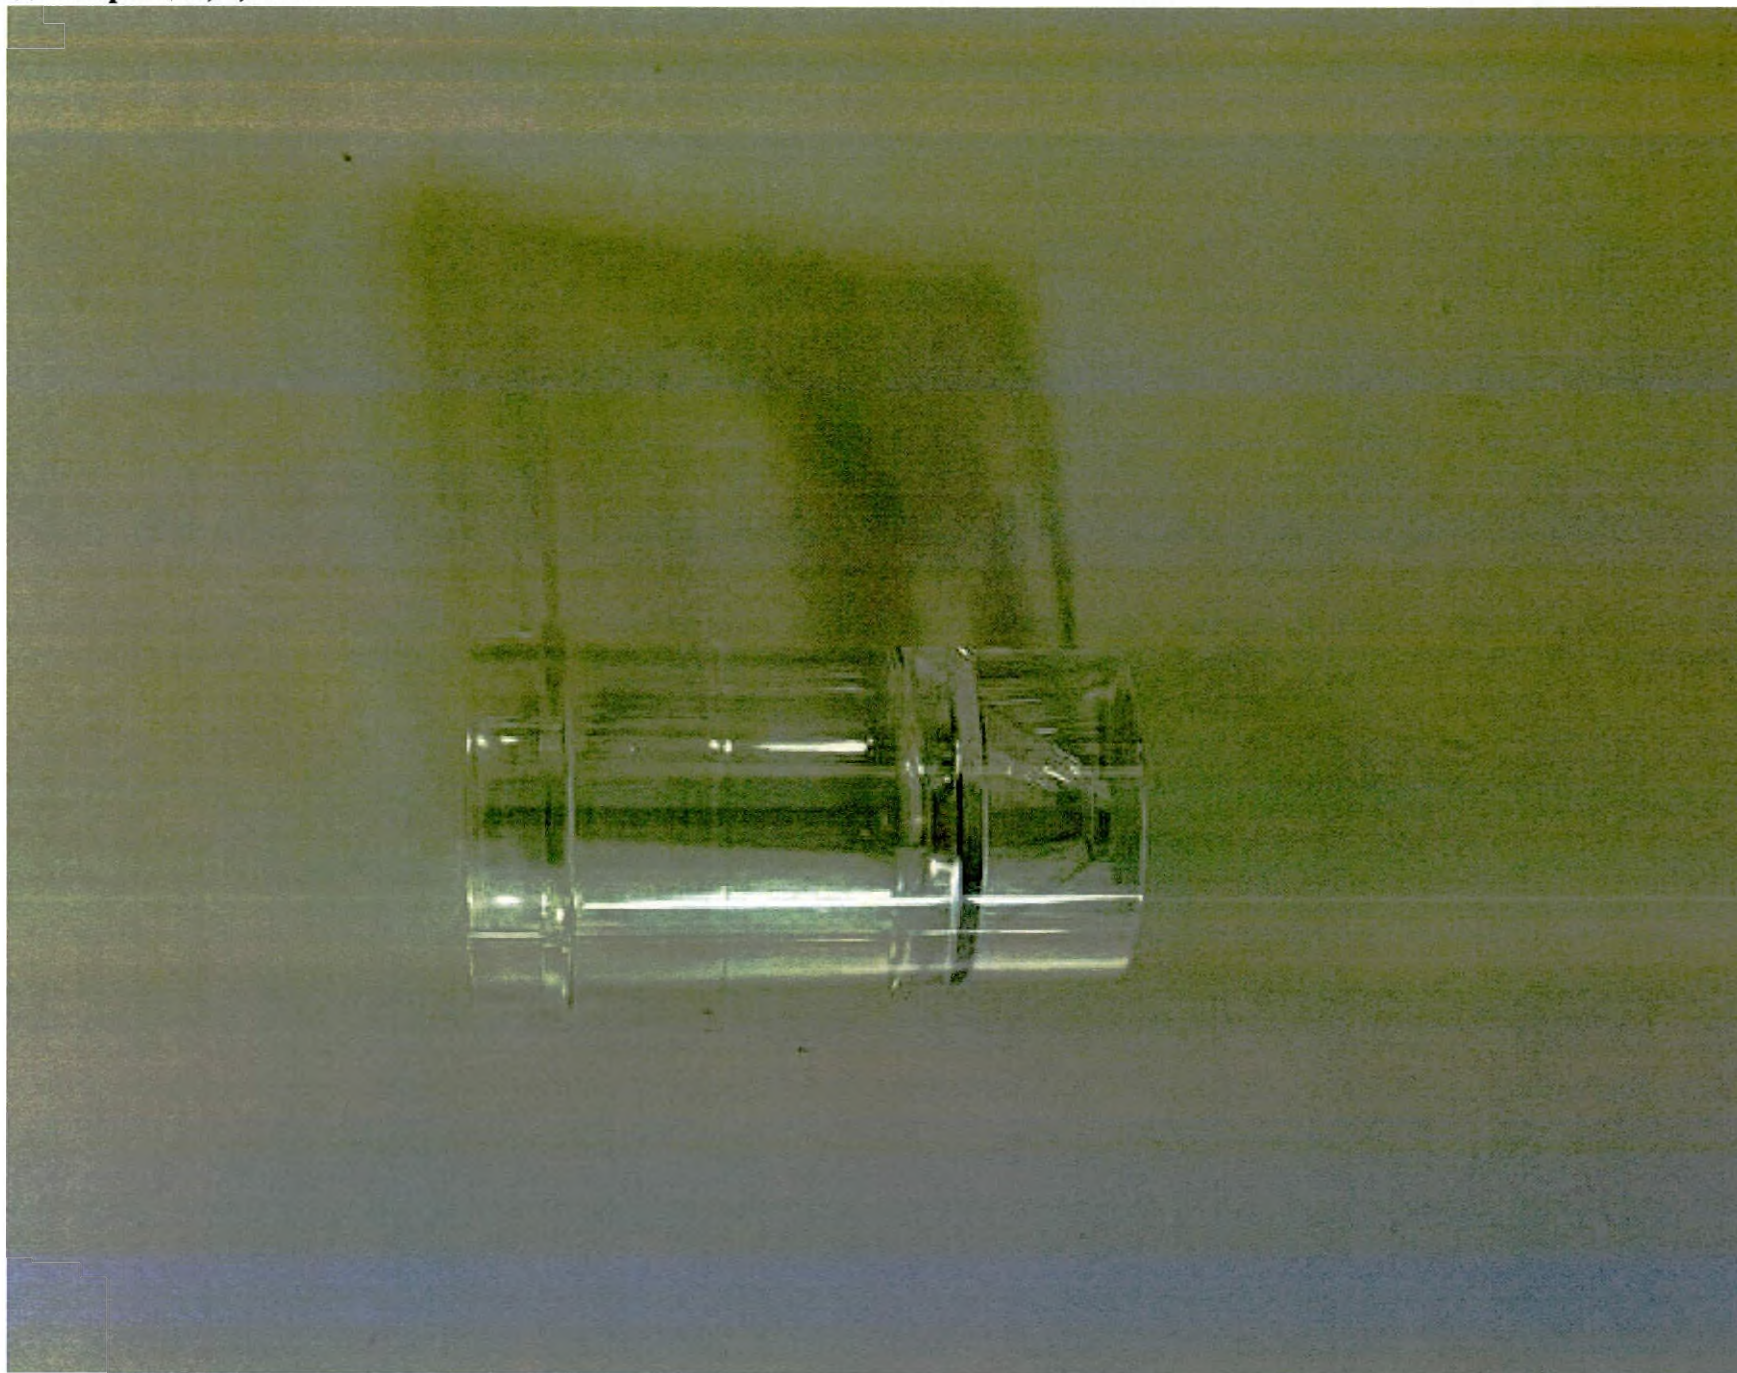


Штатив для проведения обслуживания

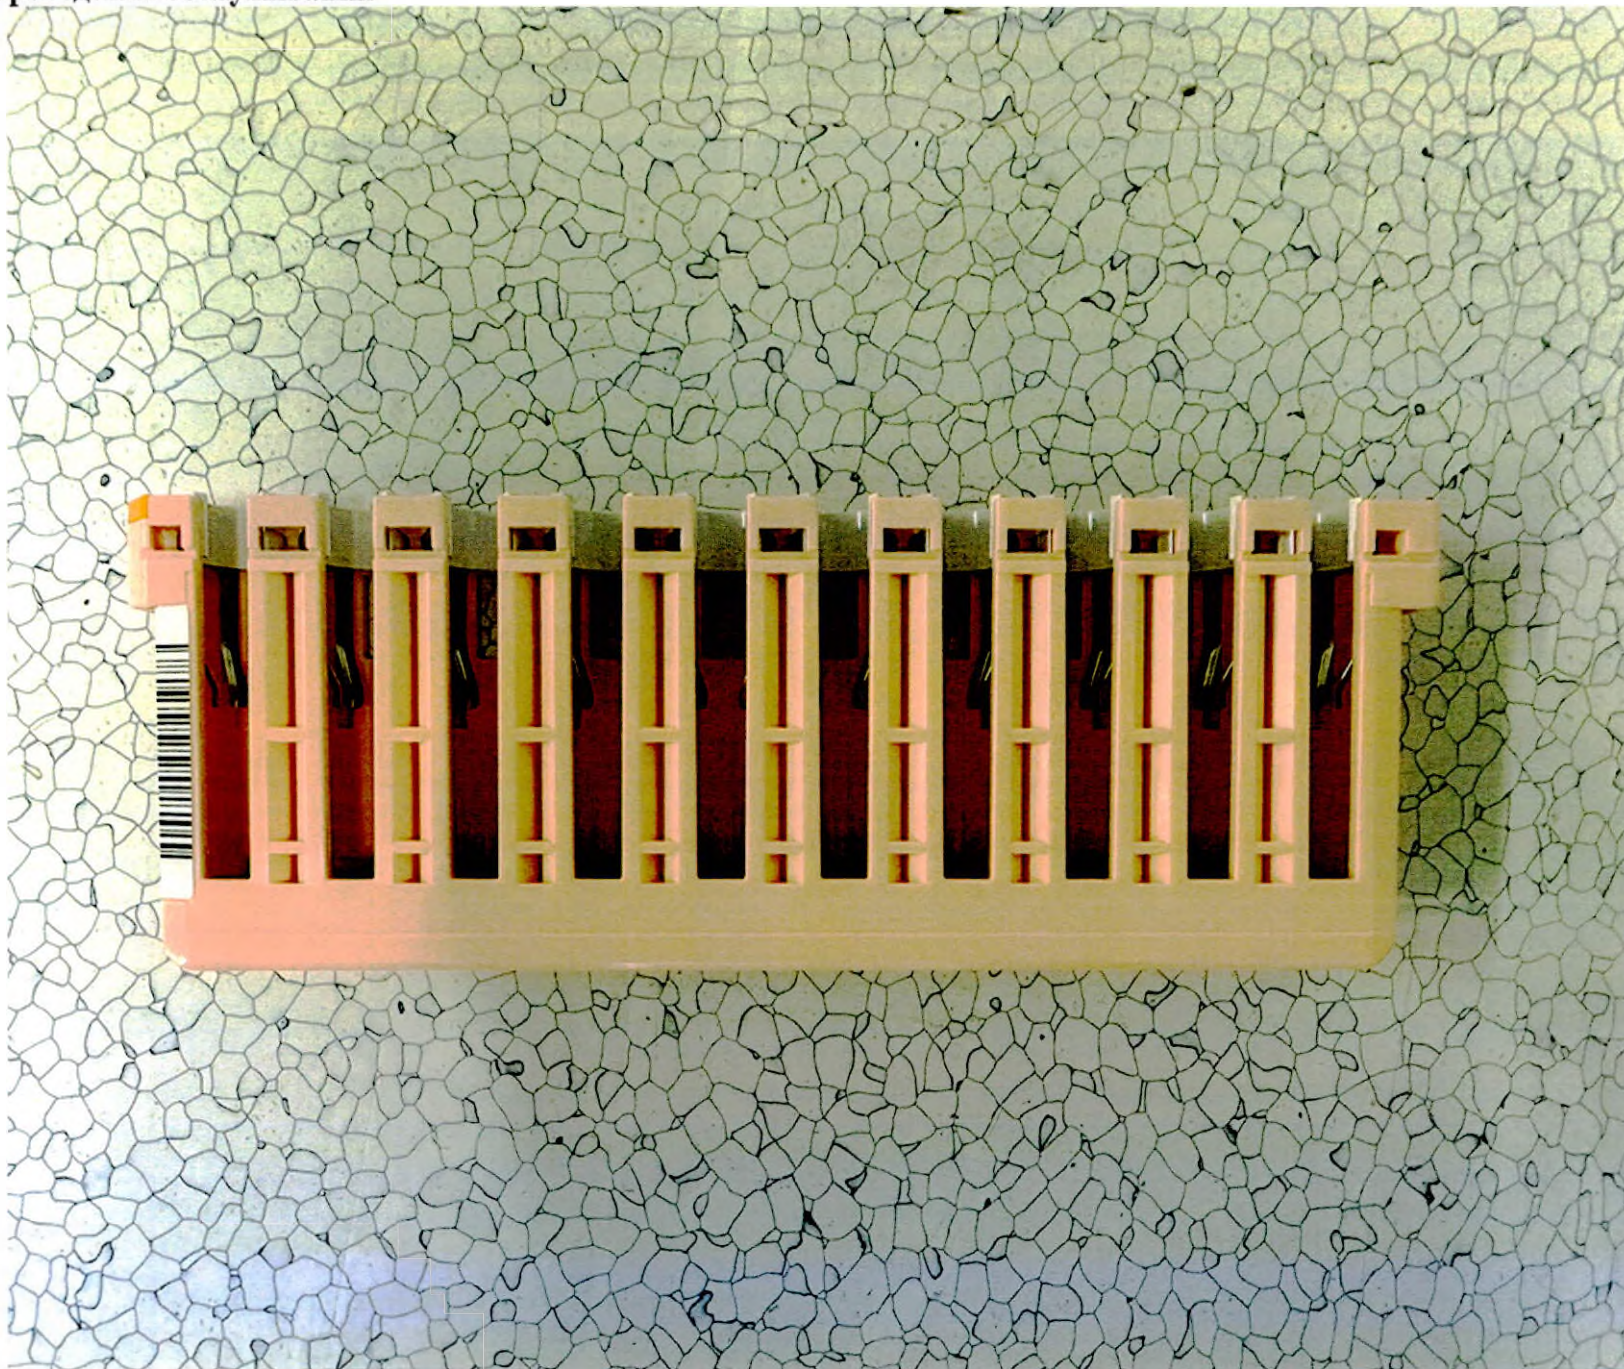


Штатив для калибраторов

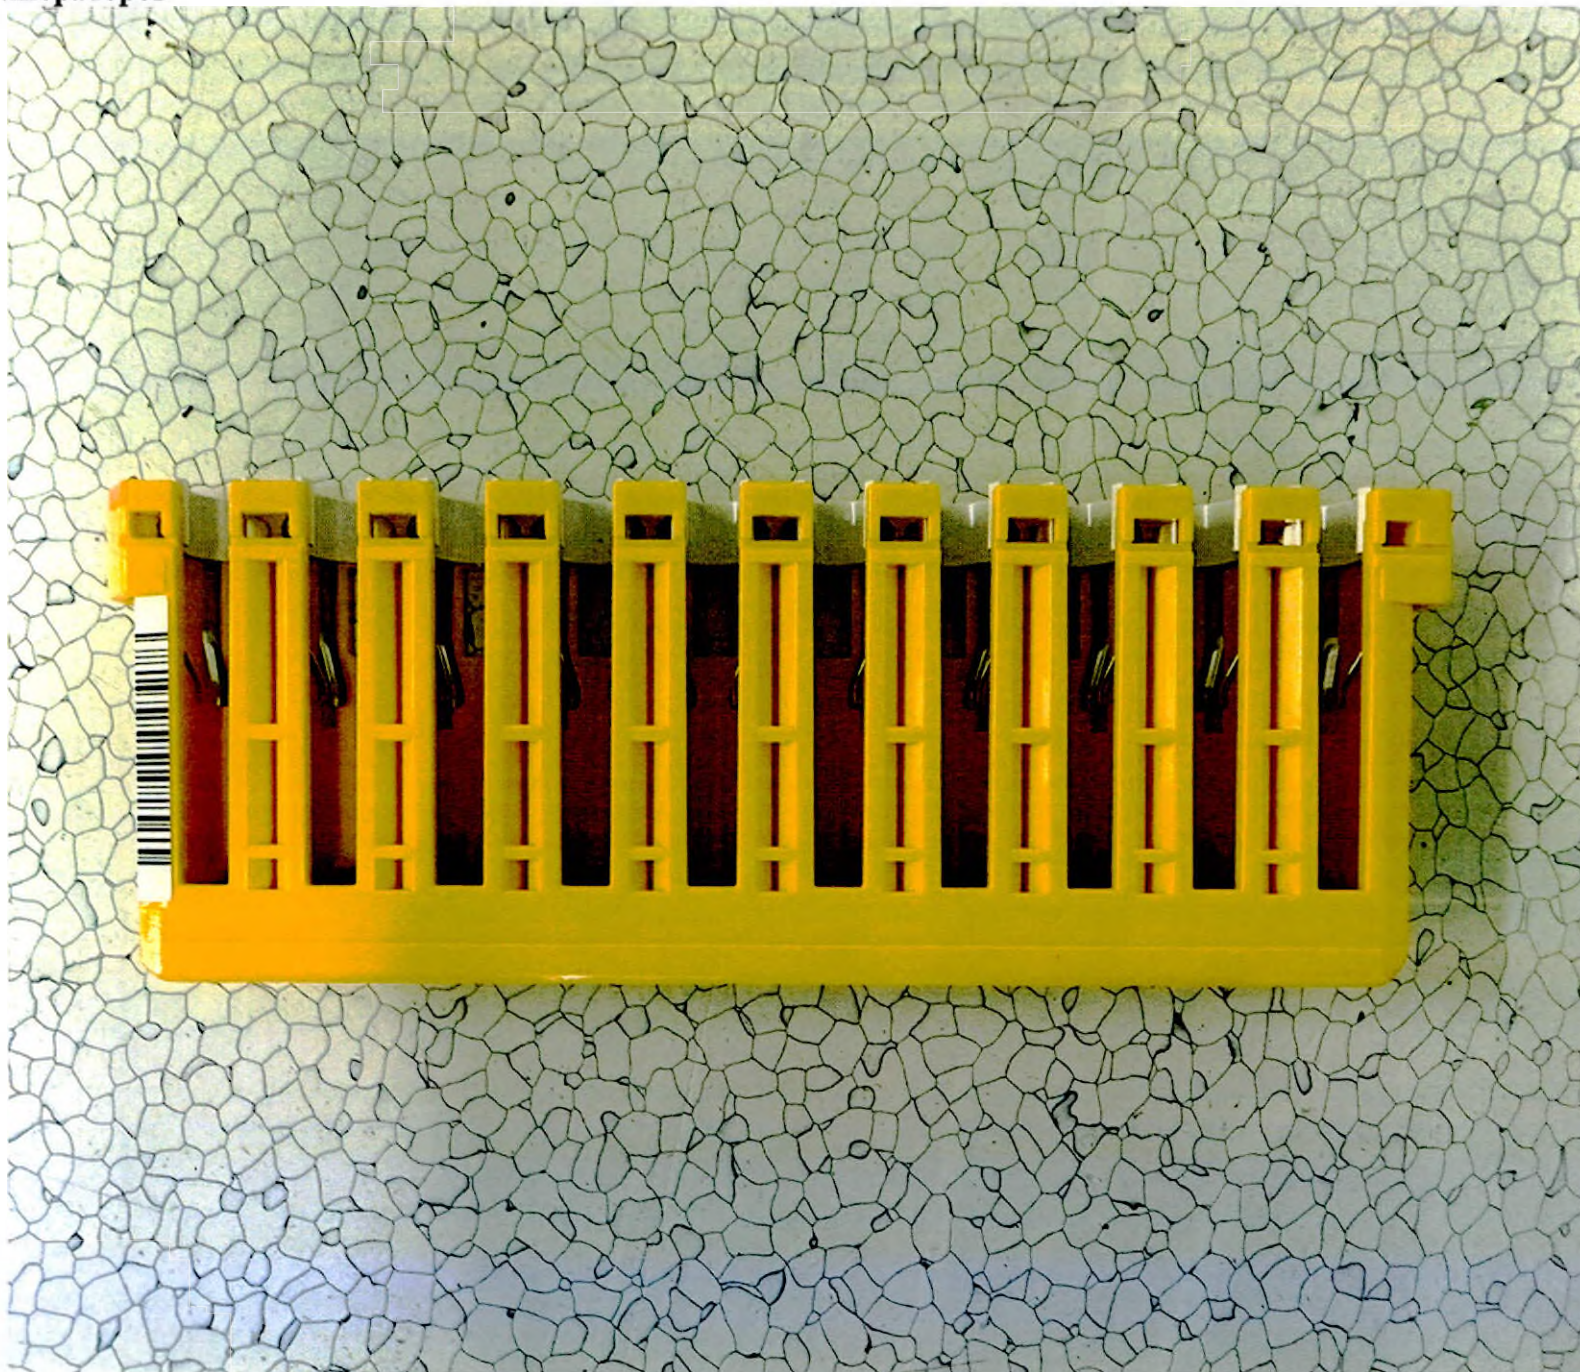


Штатив для срочных образцов

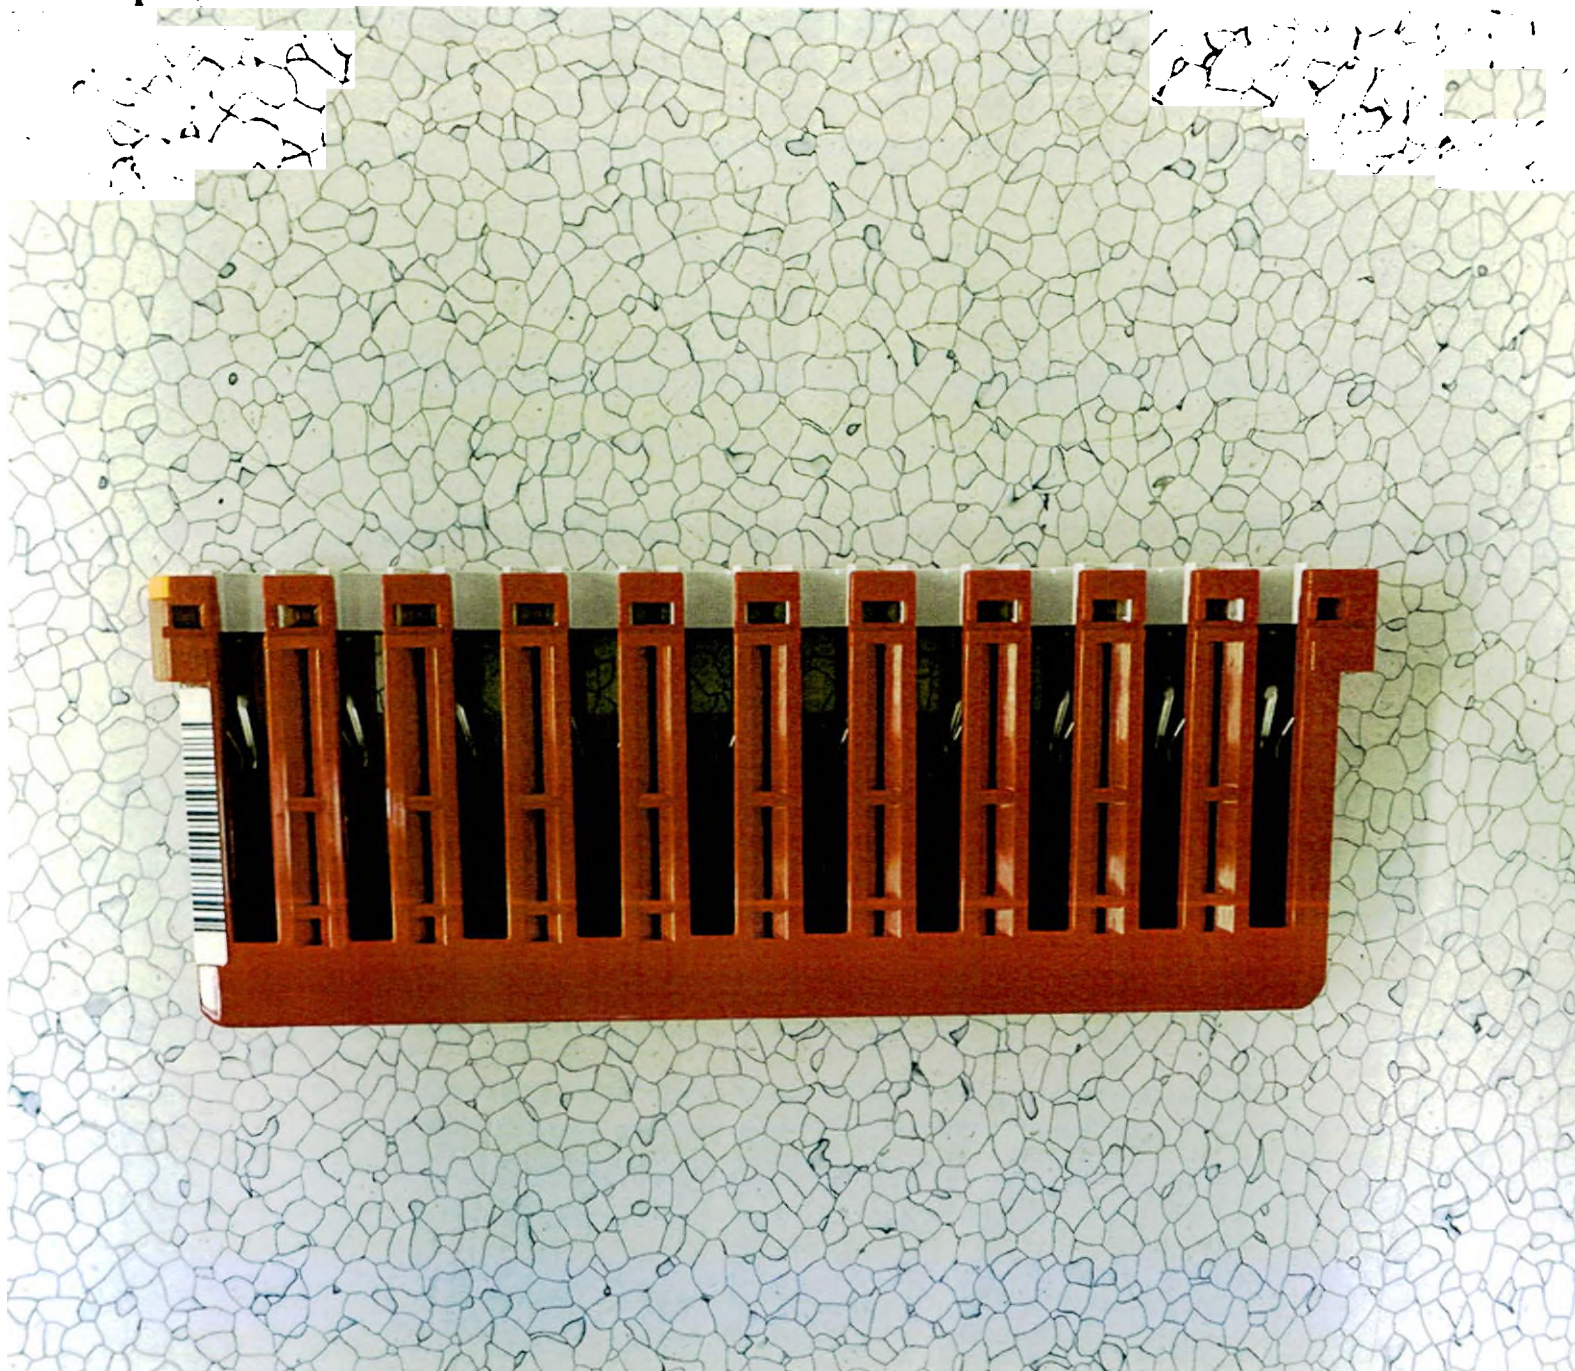


Штатив для контрольных образцов

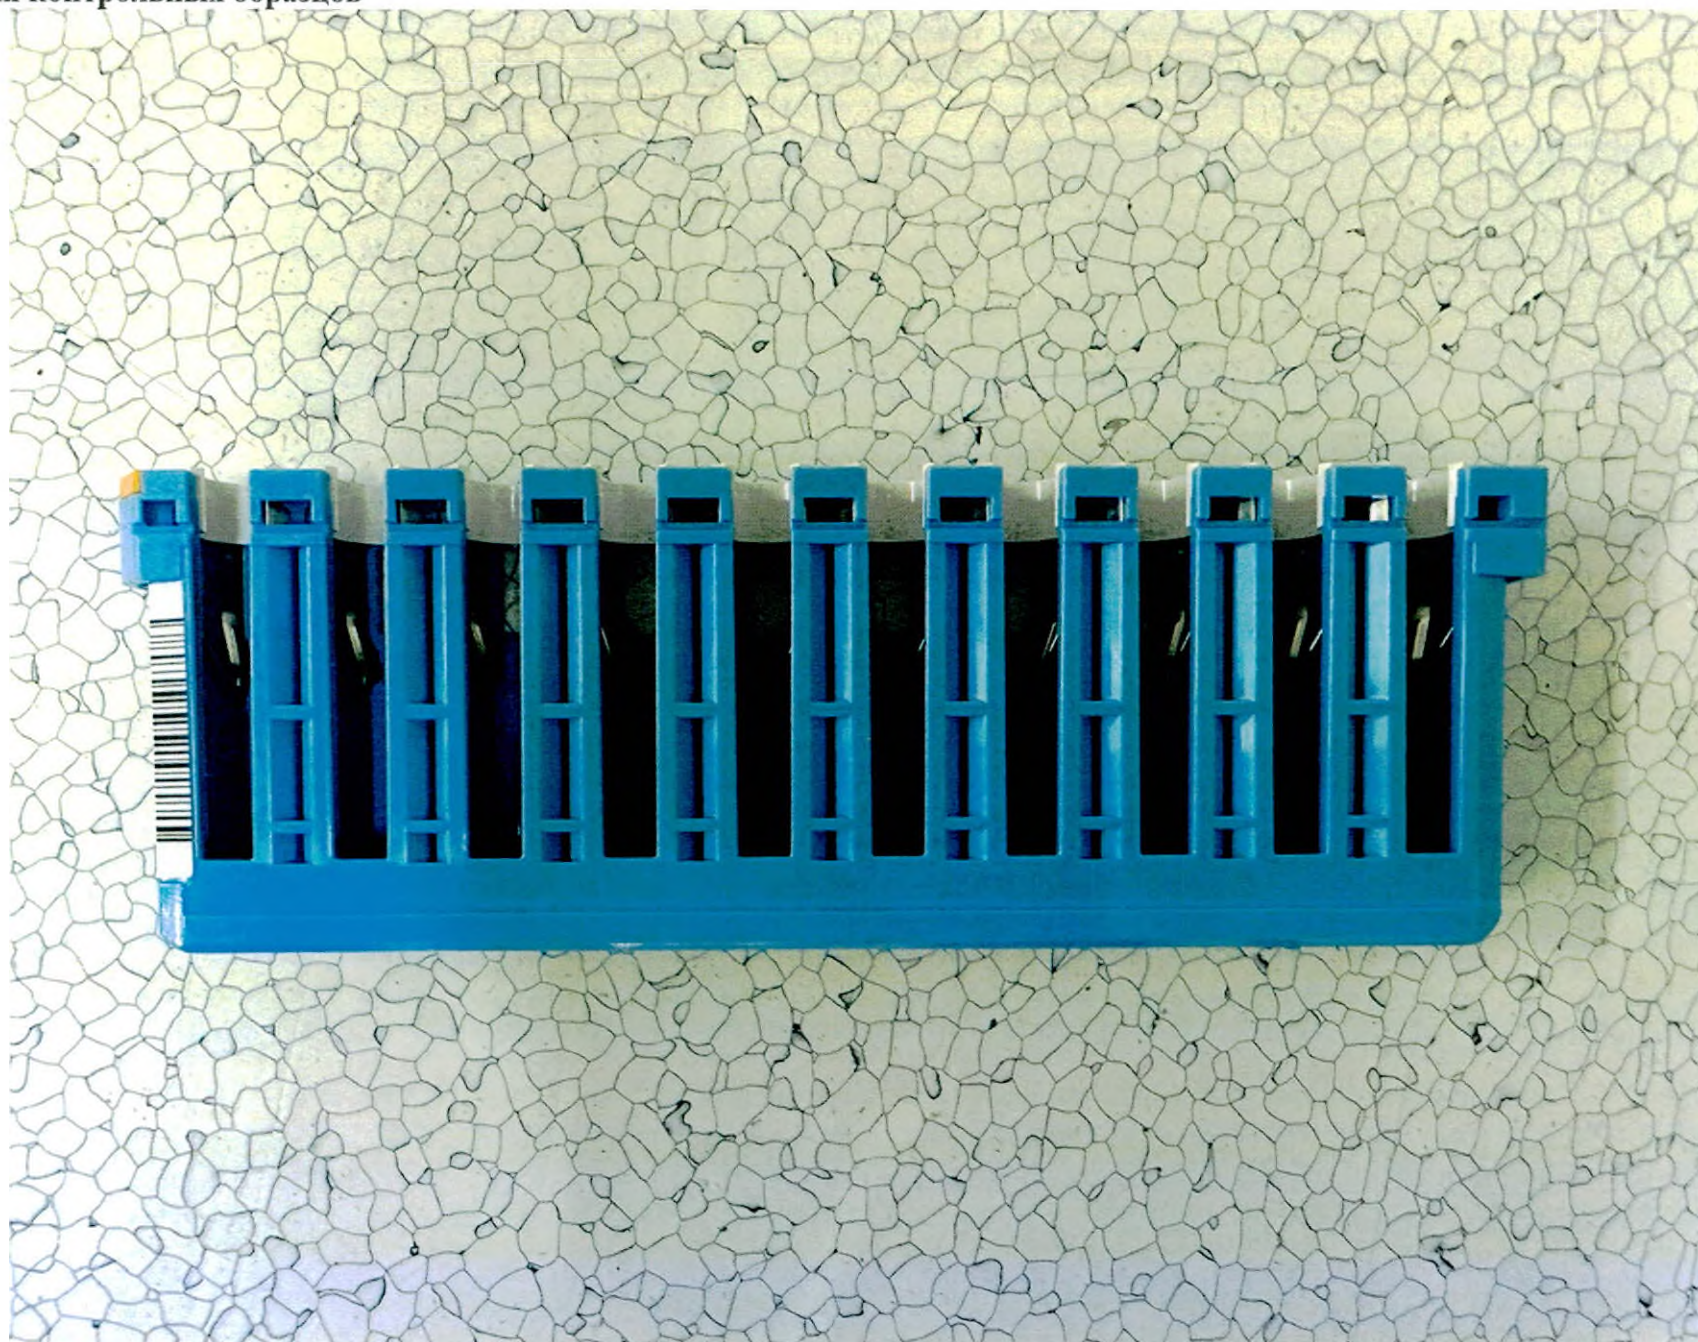


Штатив для повторных образцов

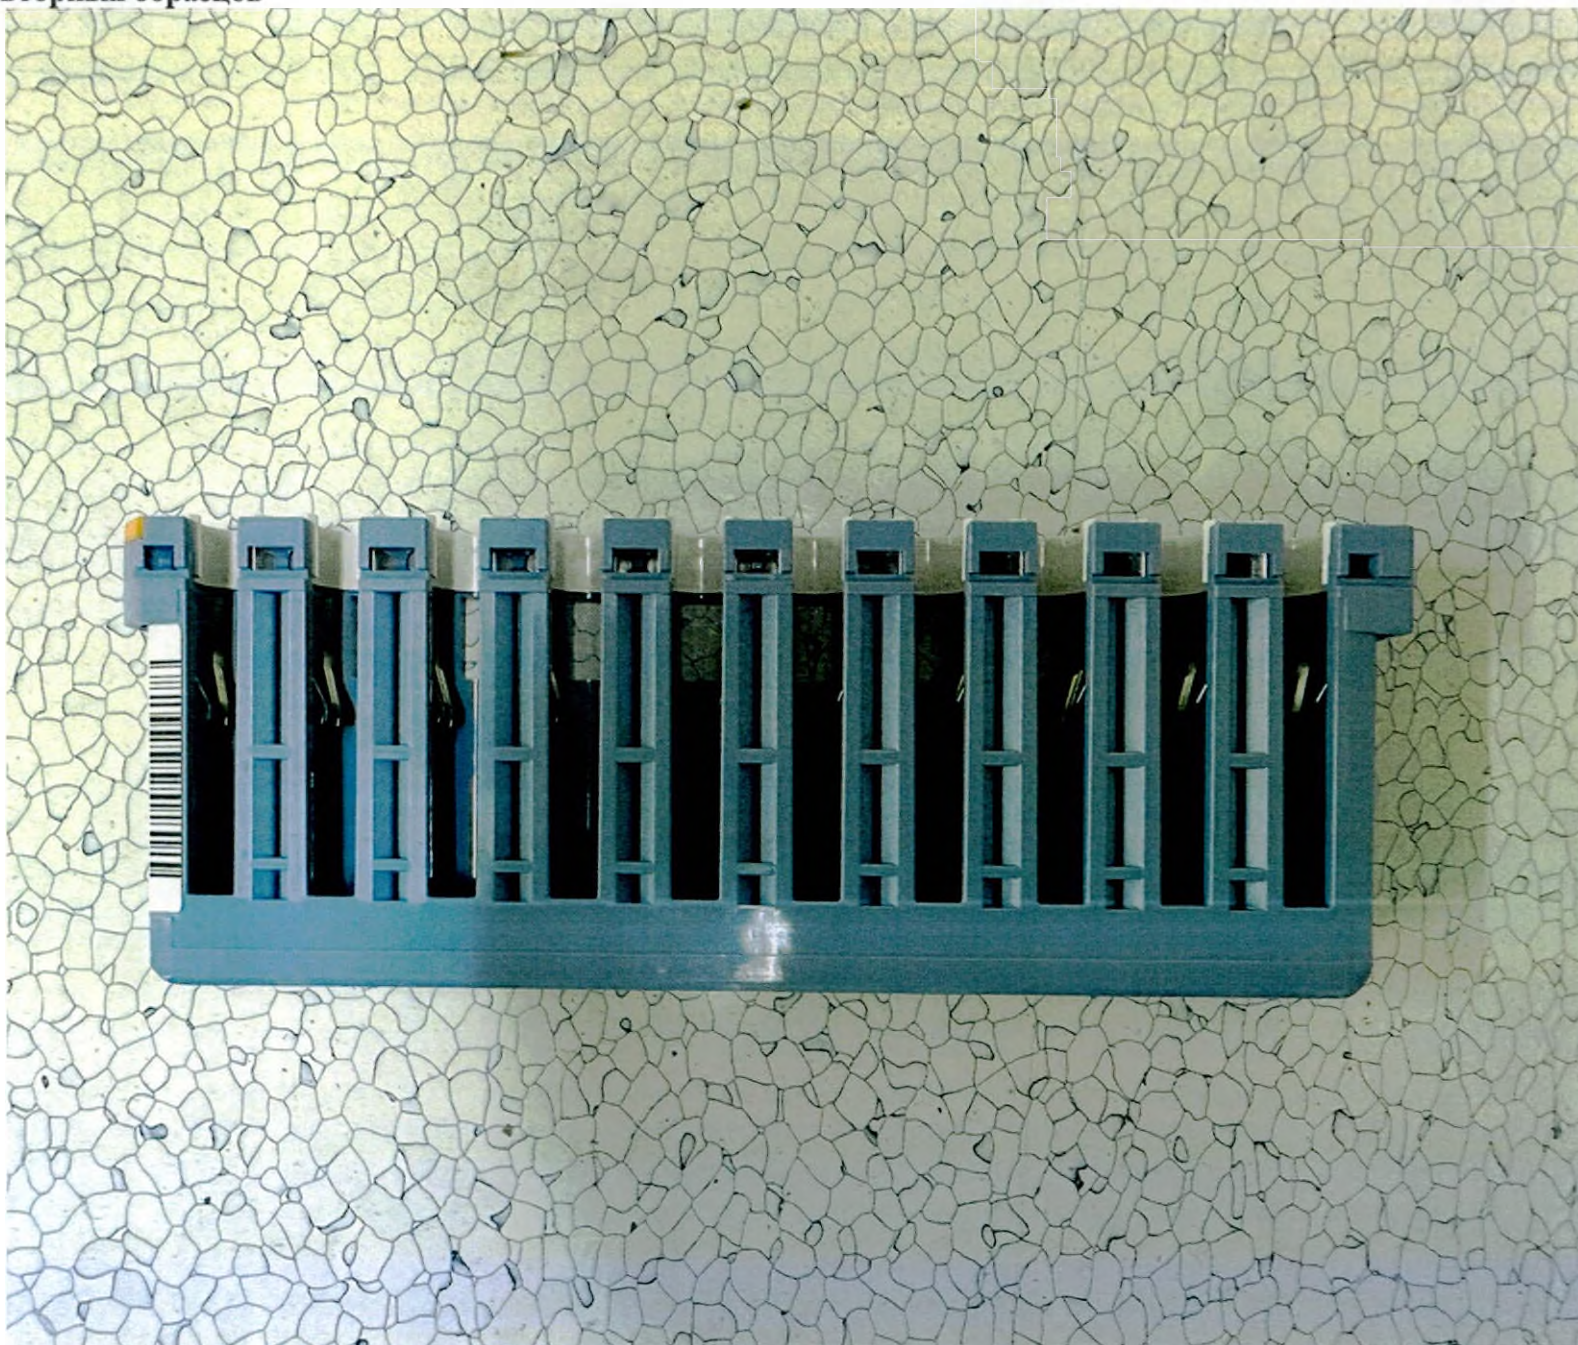


Штатив для рутинных образцов

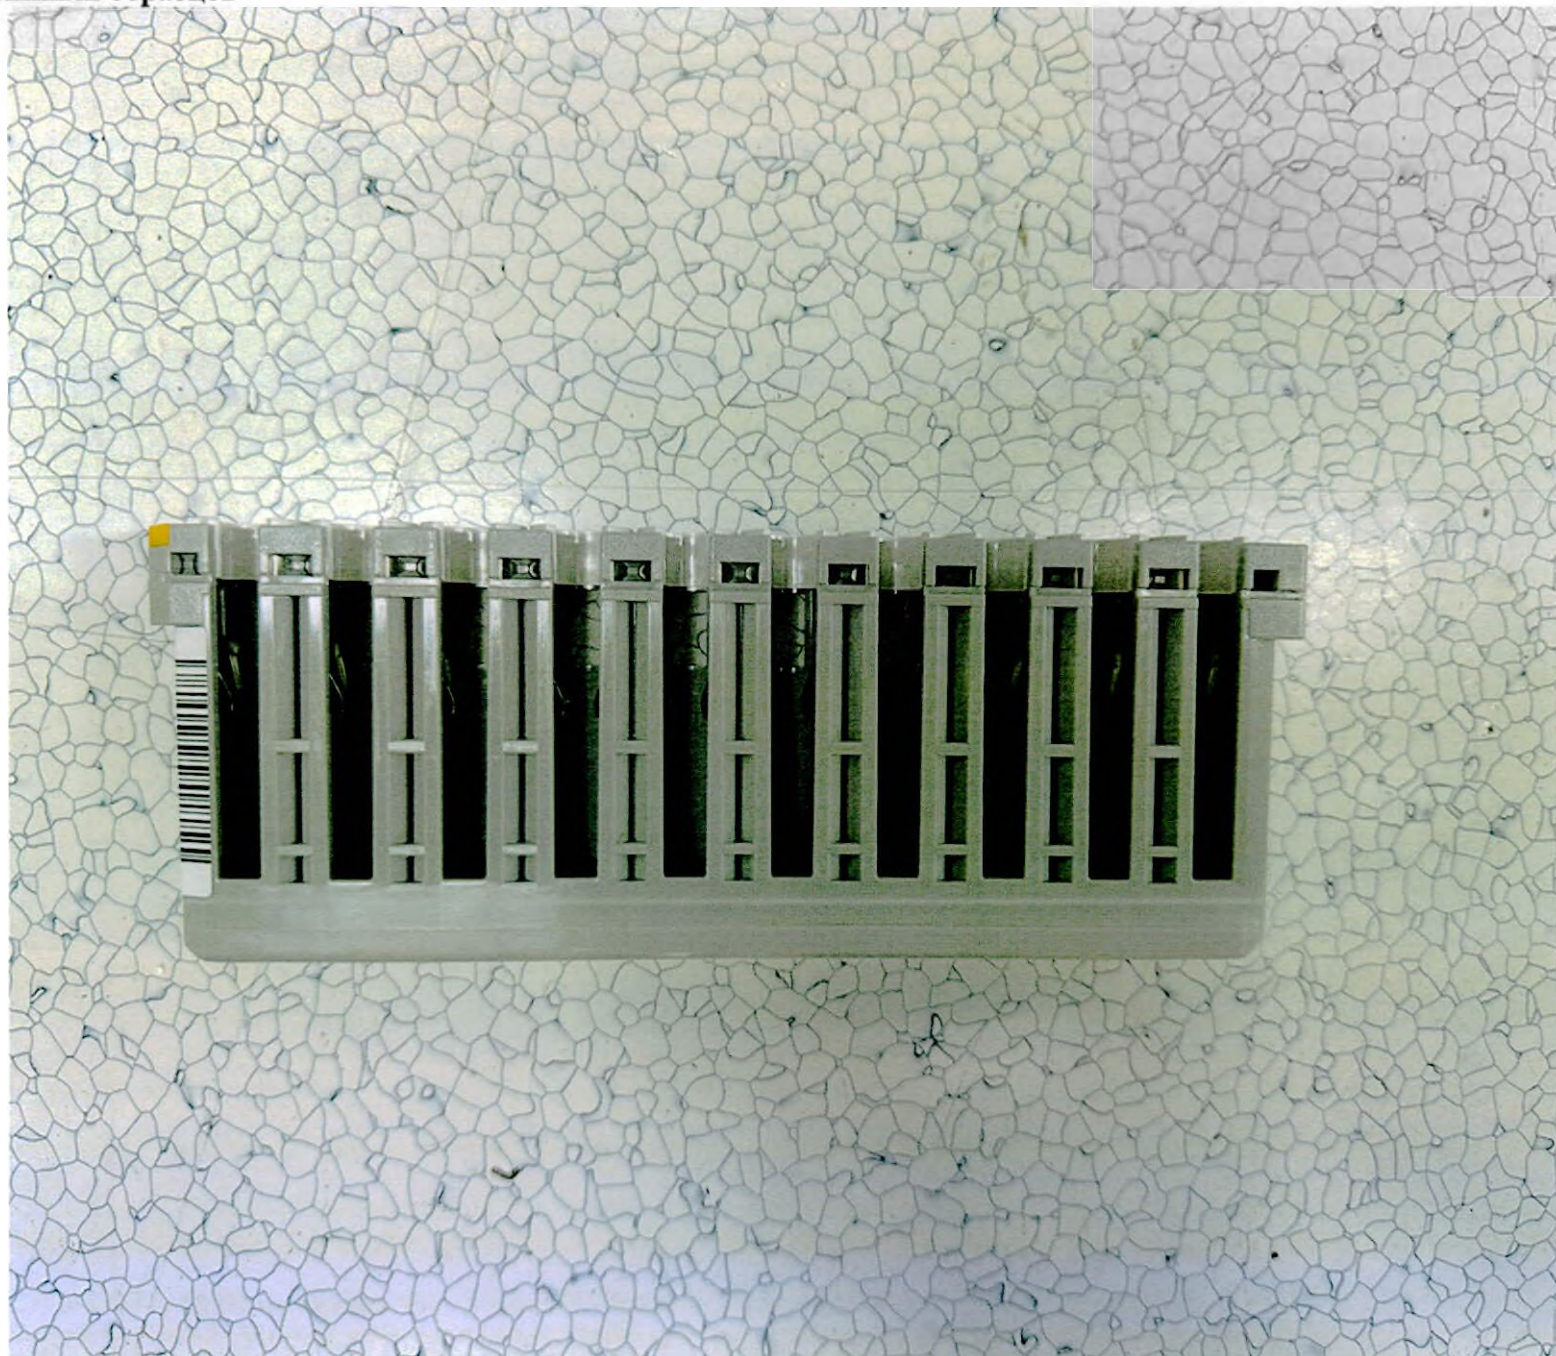


Дозатор для реагентов в сборе

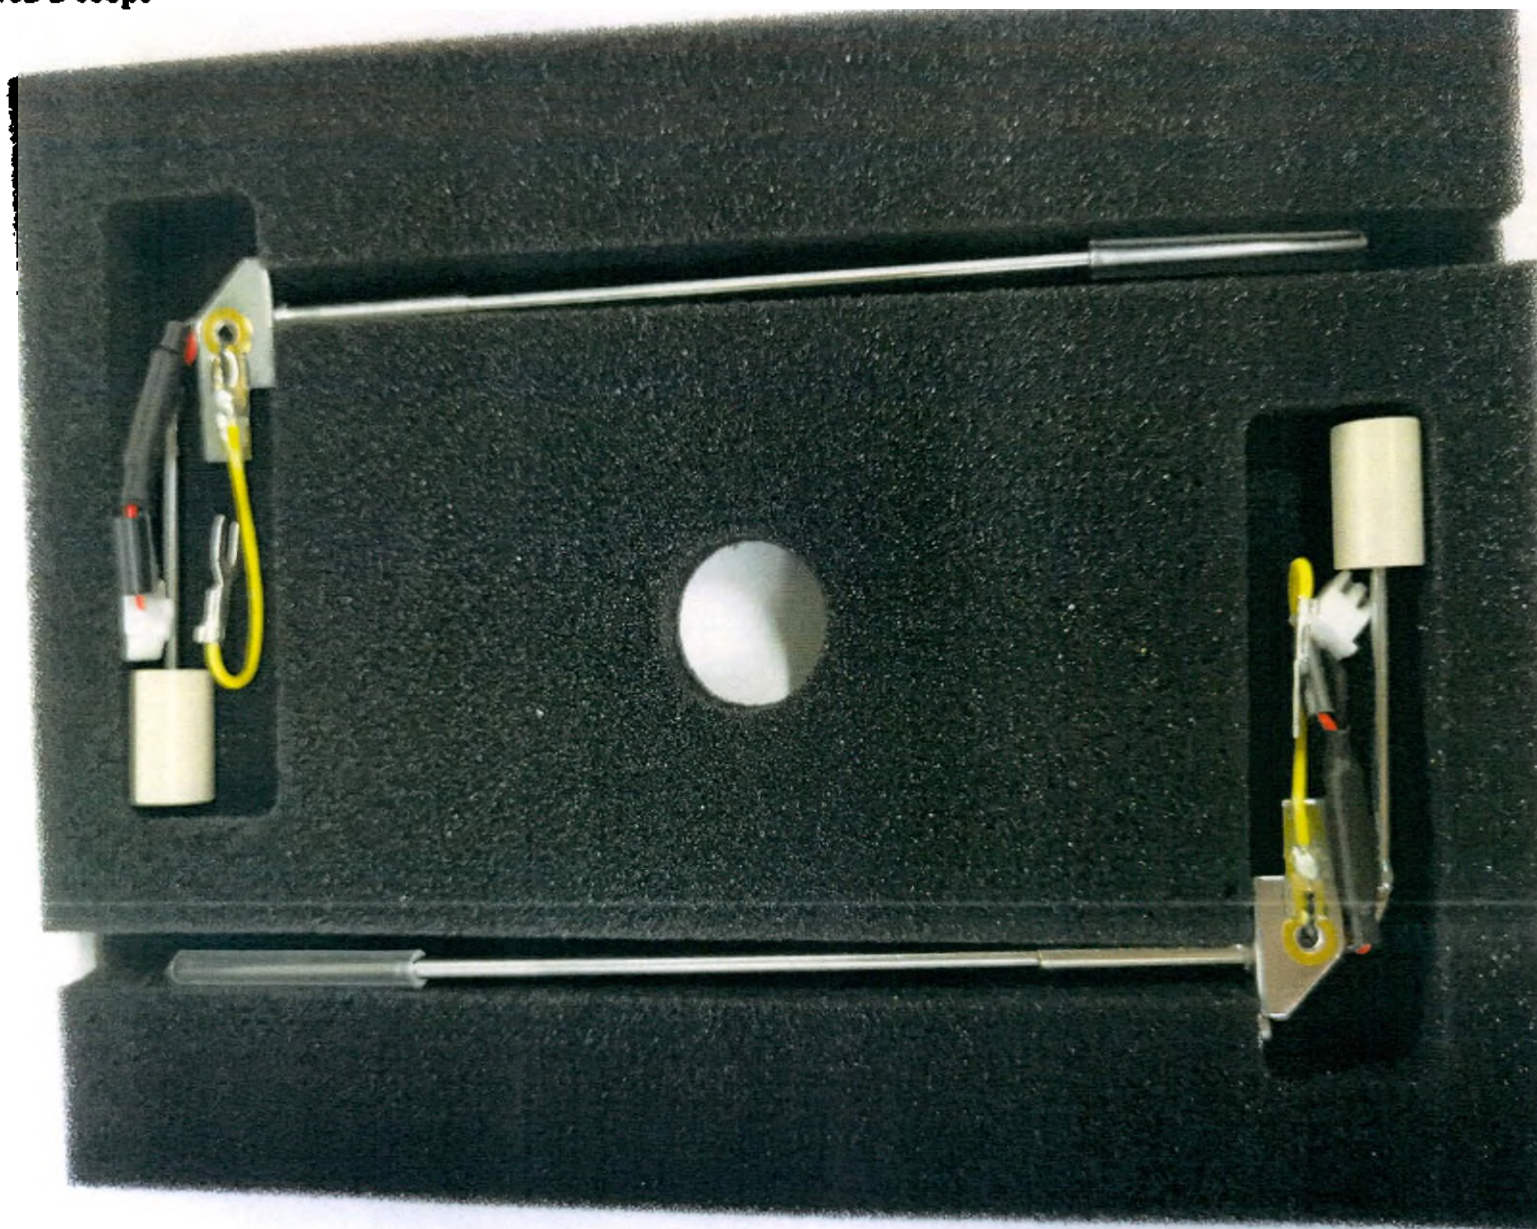


Двойная игла пробоотборника

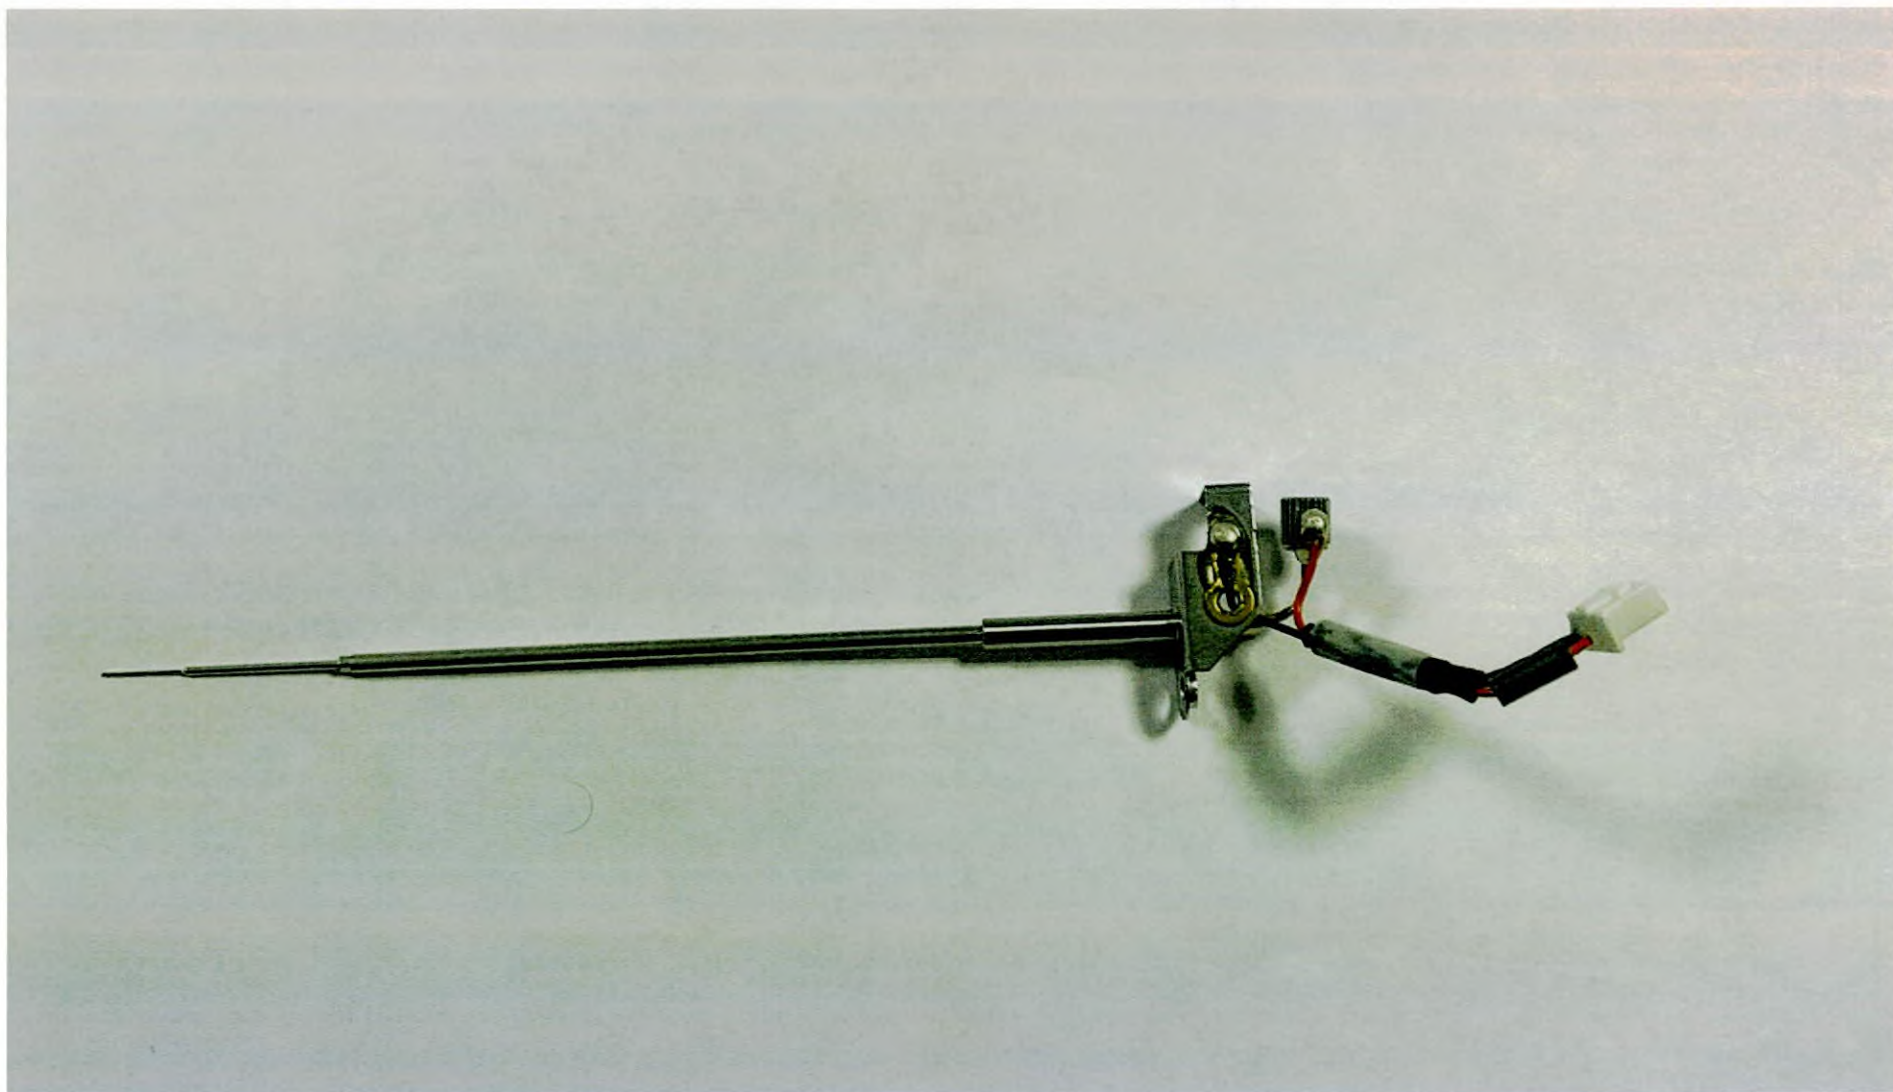

Дозатор для образца

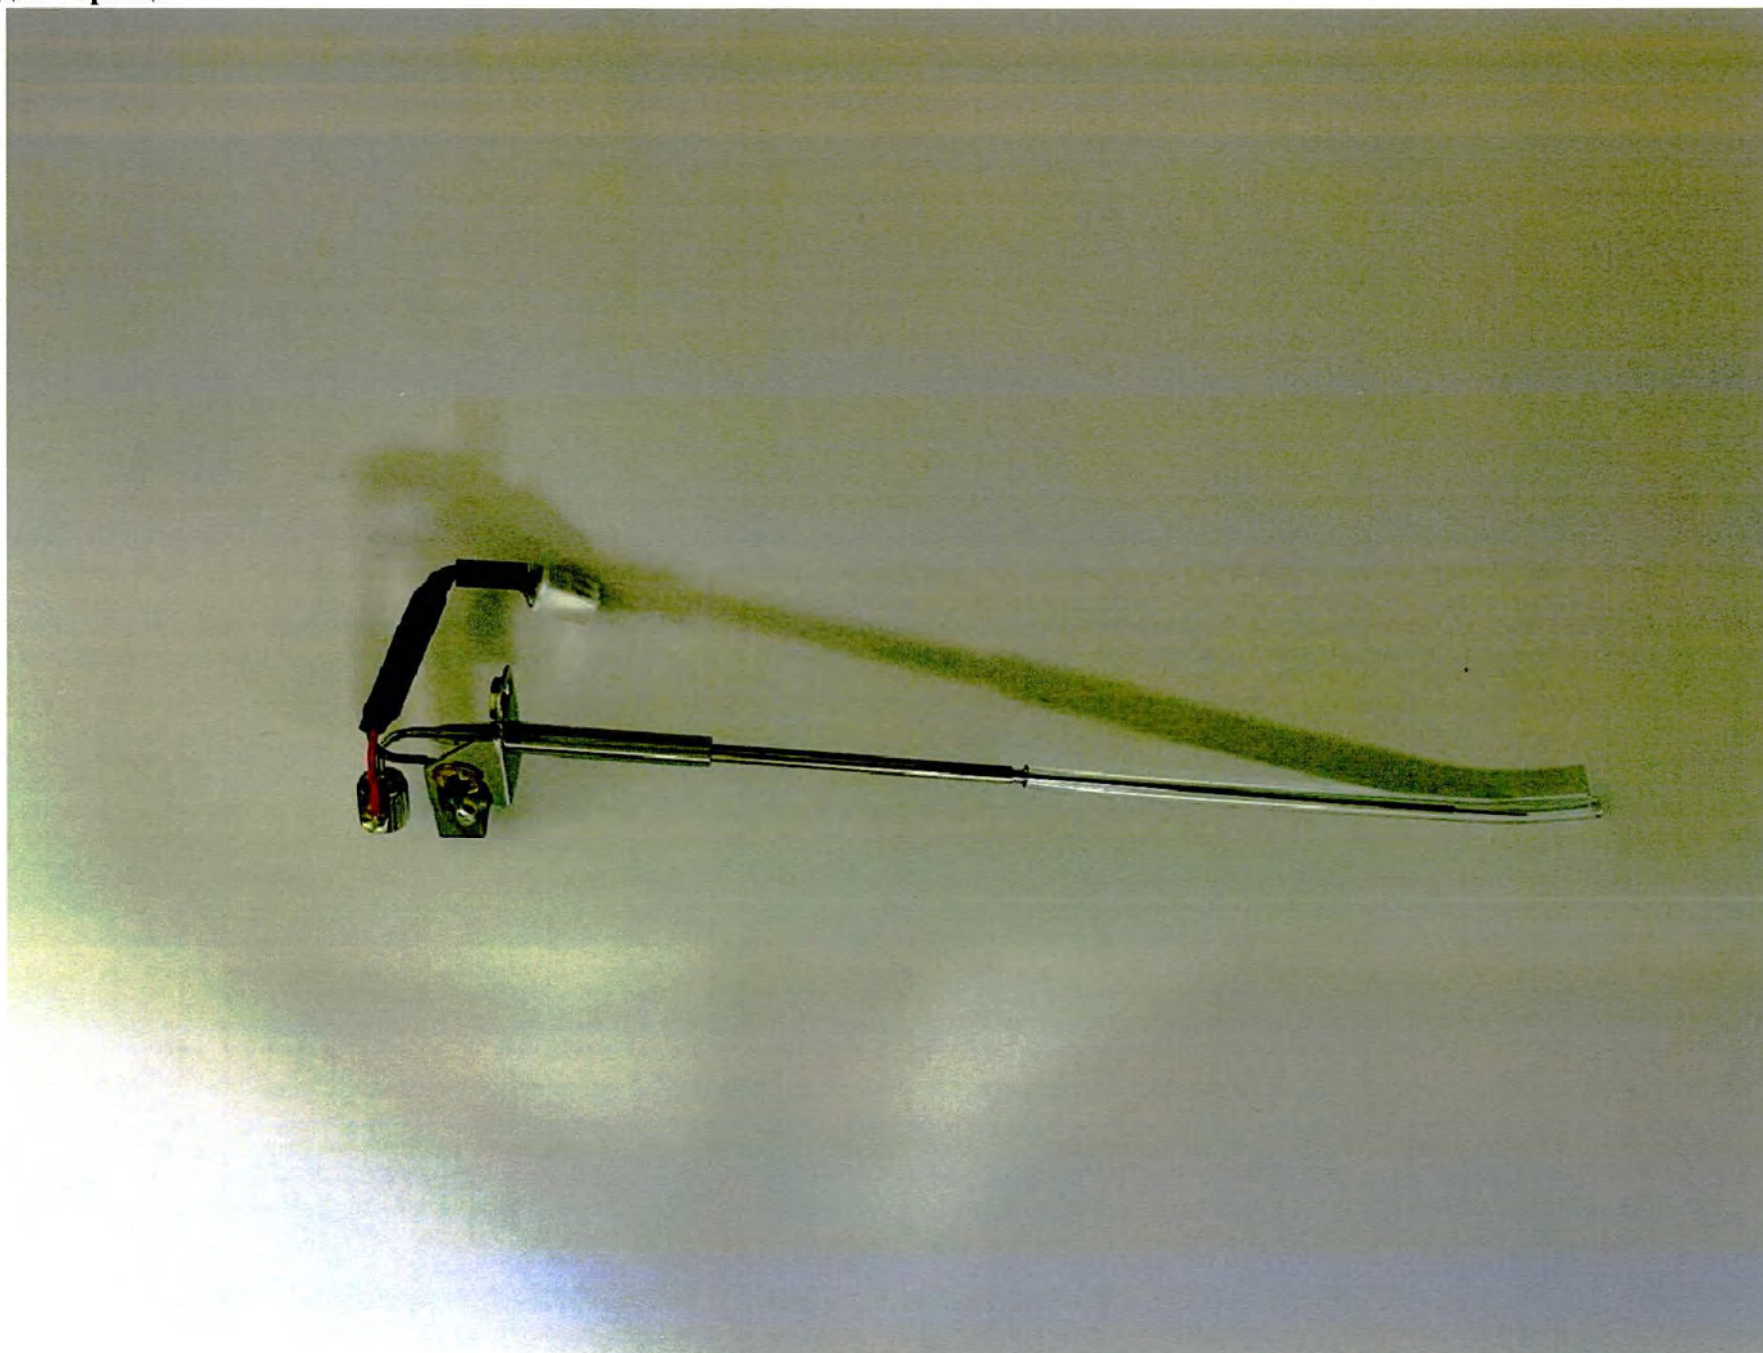

Лопатка миксера – не более 12 шт. (при необходимости).

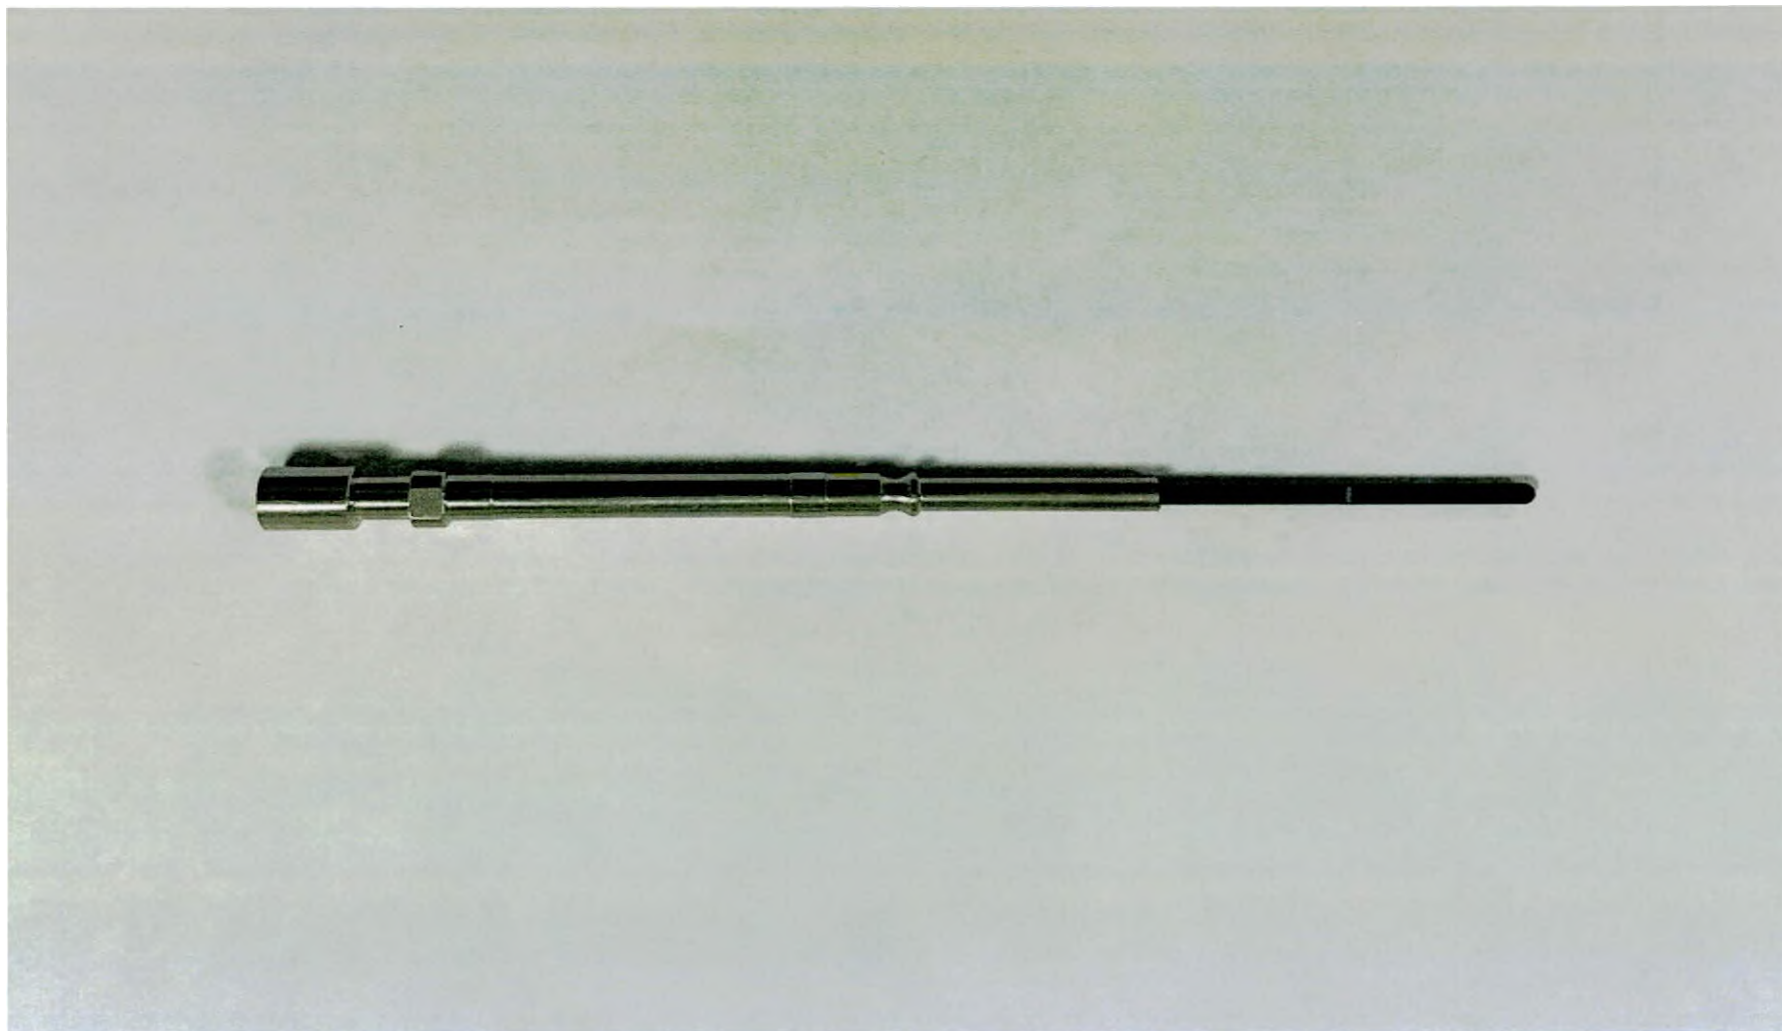

Наклейки для флакона для реагента

试剂名称	试剂名称	试剂名称	试剂名称	试剂名称
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY

试剂名称	试剂名称	试剂名称	试剂名称	试剂名称
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY

CODE128



3000100151

CODE128




3000100152

CODE128



3000100153

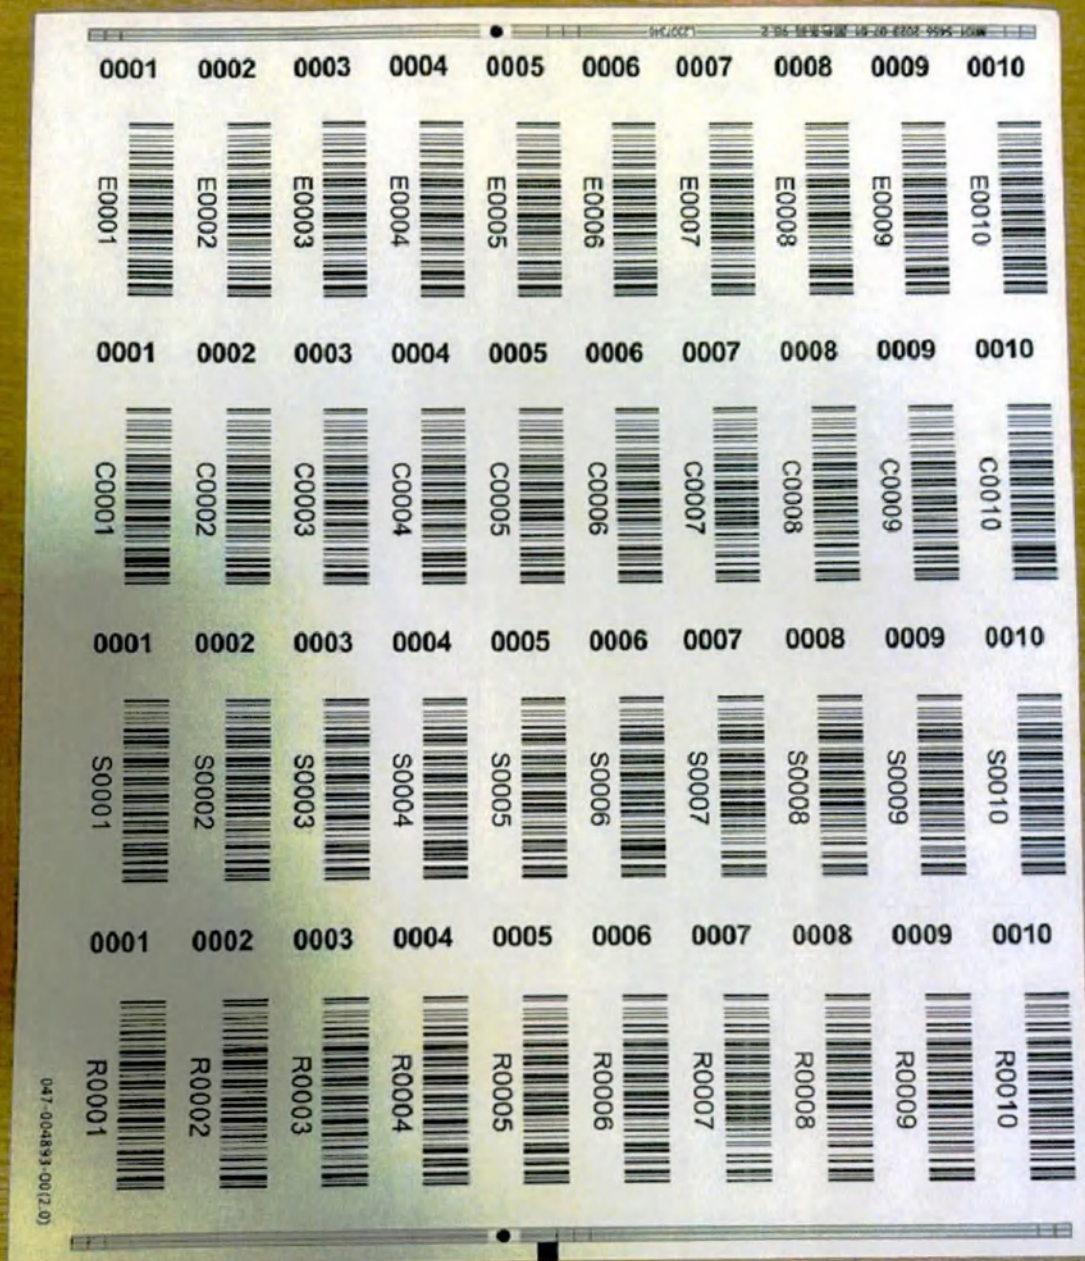


Наклейки со штрих-кодом N

0001		N0001	0002		N0002	0003		N0003	0004		N0004	0005		N0005	0006		N0006	0007		N0007	0008		N0008	0009		N0009	0010		N0010
0011		N0011	0012		N0012	0013		N0013	0014		N0014	0015		N0015	0016		N0016	0017		N0017	0018		N0018	0019		N0019	0020		N0020
0021		N0021	0022		N0022	0023		N0023	0024		N0024	0025		N0025	0026		N0026	0027		N0027	0028		N0028	0029		N0029	0030		N0030
0031		N0031	0032		N0032	0033		N0033	0034		N0034	0035		N0035	0036		N0036	0037		N0037	0038		N0038	0039		N0039	0040		N0040
0041		N0041	0042		N0042	0043		N0043	0044		N0044	0045		N0045	0046		N0046	0047		N0047	0048		N0048	0049		N0049	0050		N0050

047-004892-00(2.0) sheet 1 of 2

Наклейки для держателя штативов

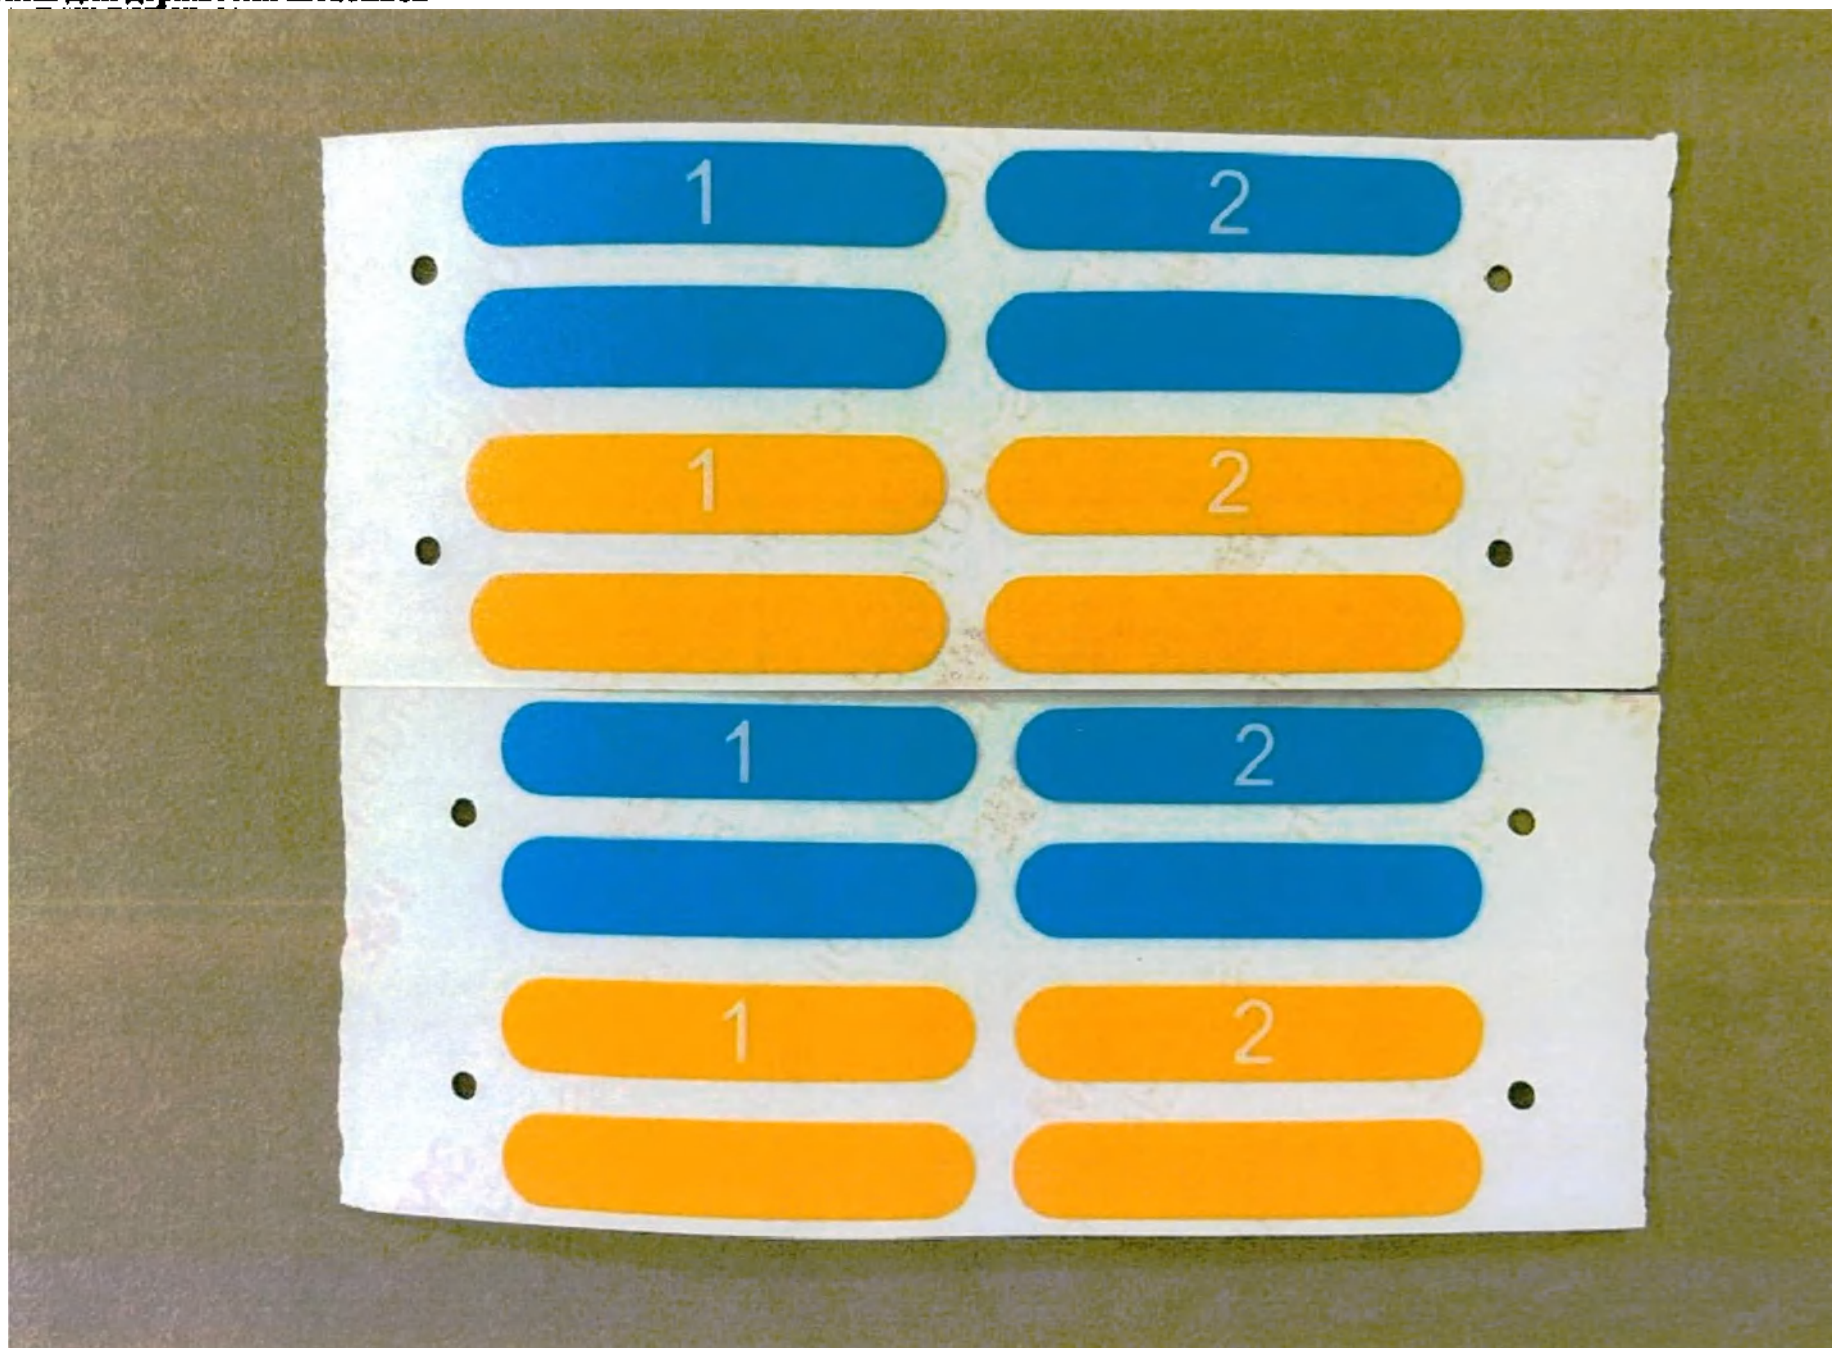




注意

谨防撞头

CAUTION

MIND YOUR HEAD


Лампа 50 Вт

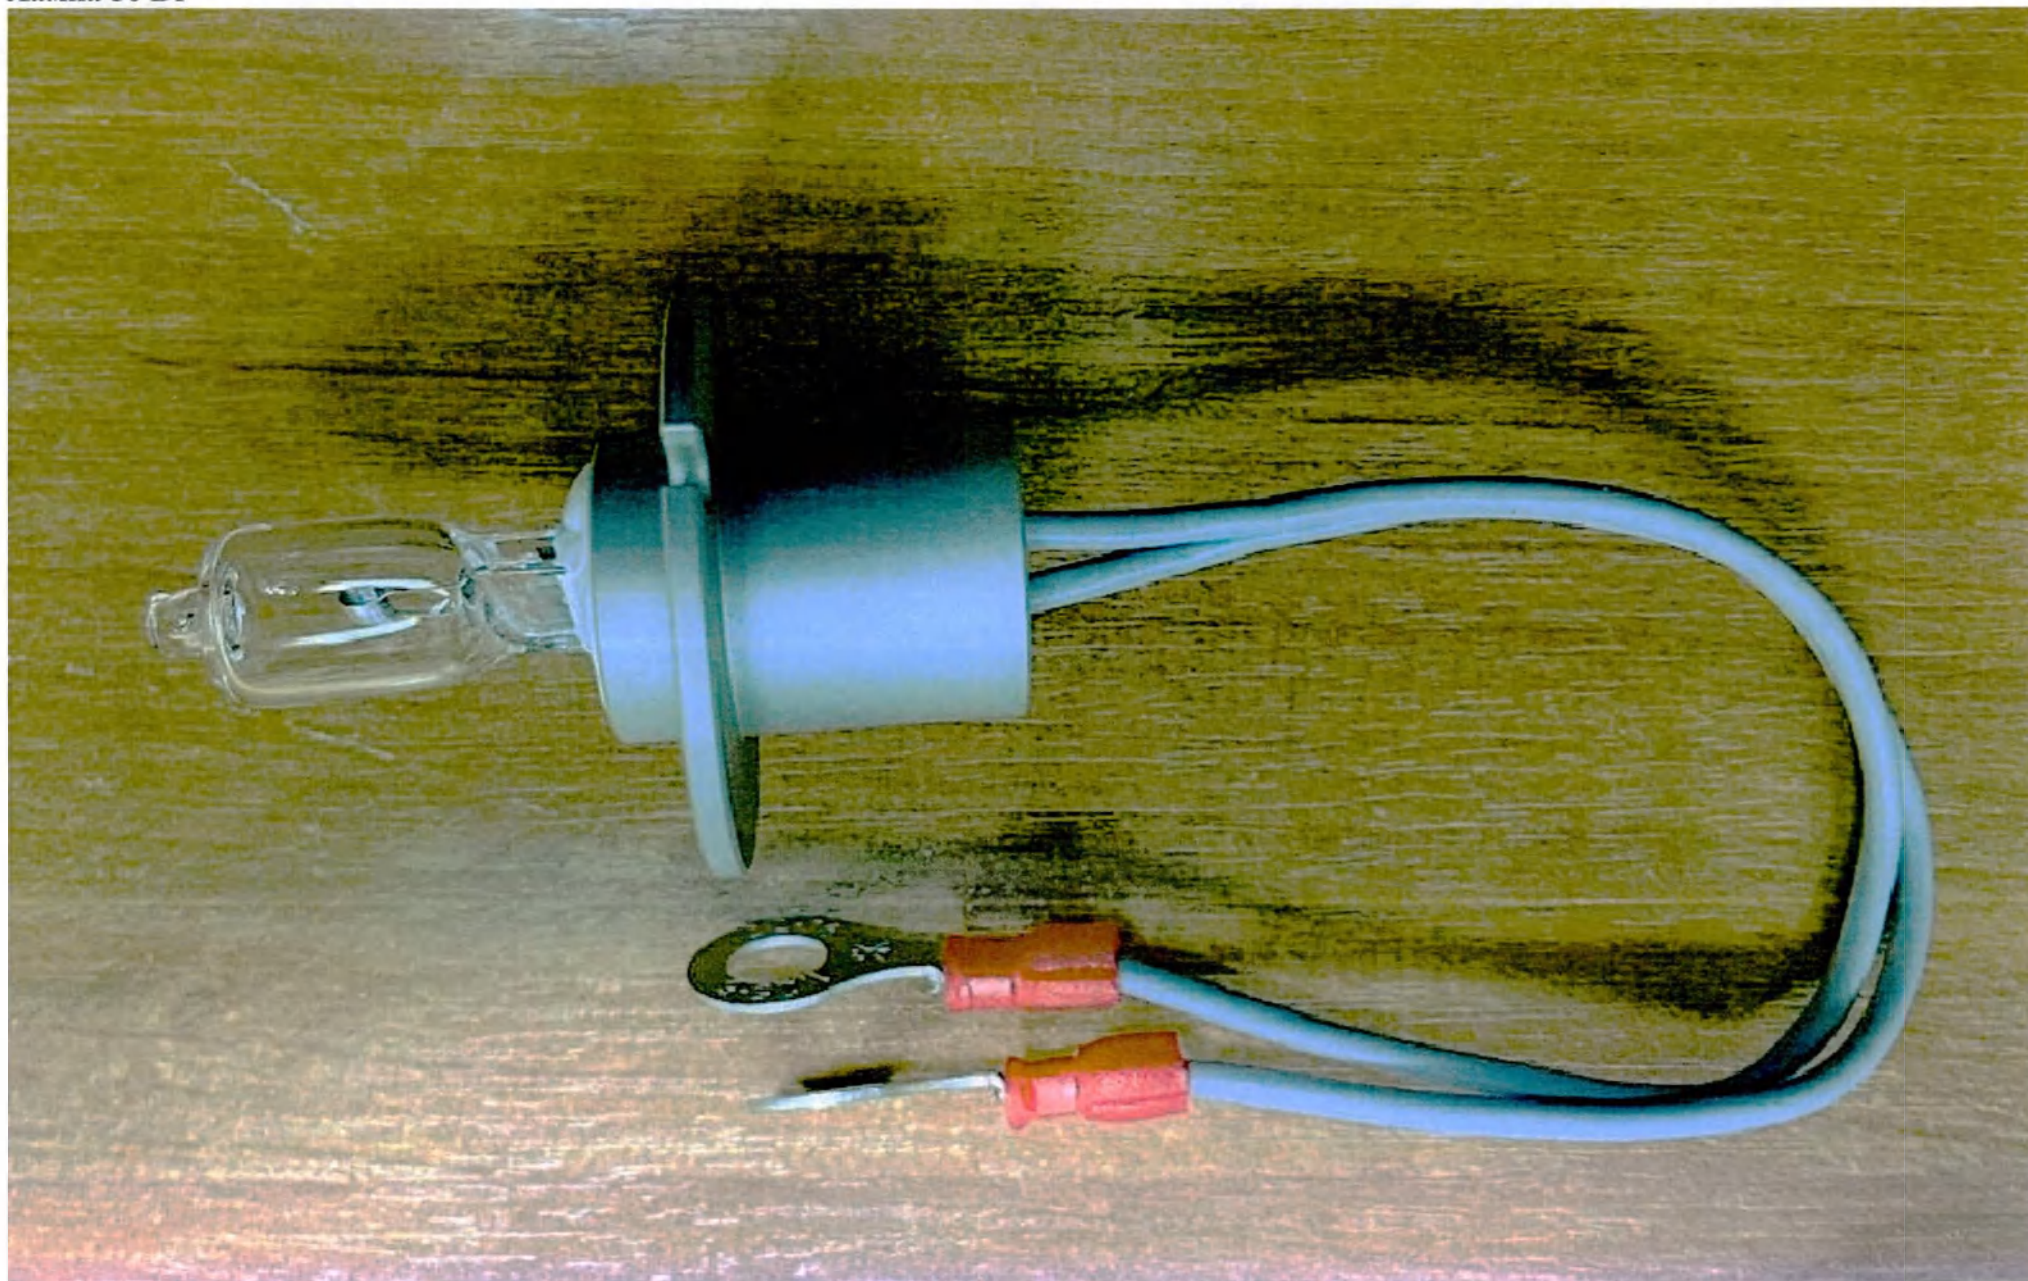


Наружный фильтр для воды




Фильтр внешнего модуля подачи воды

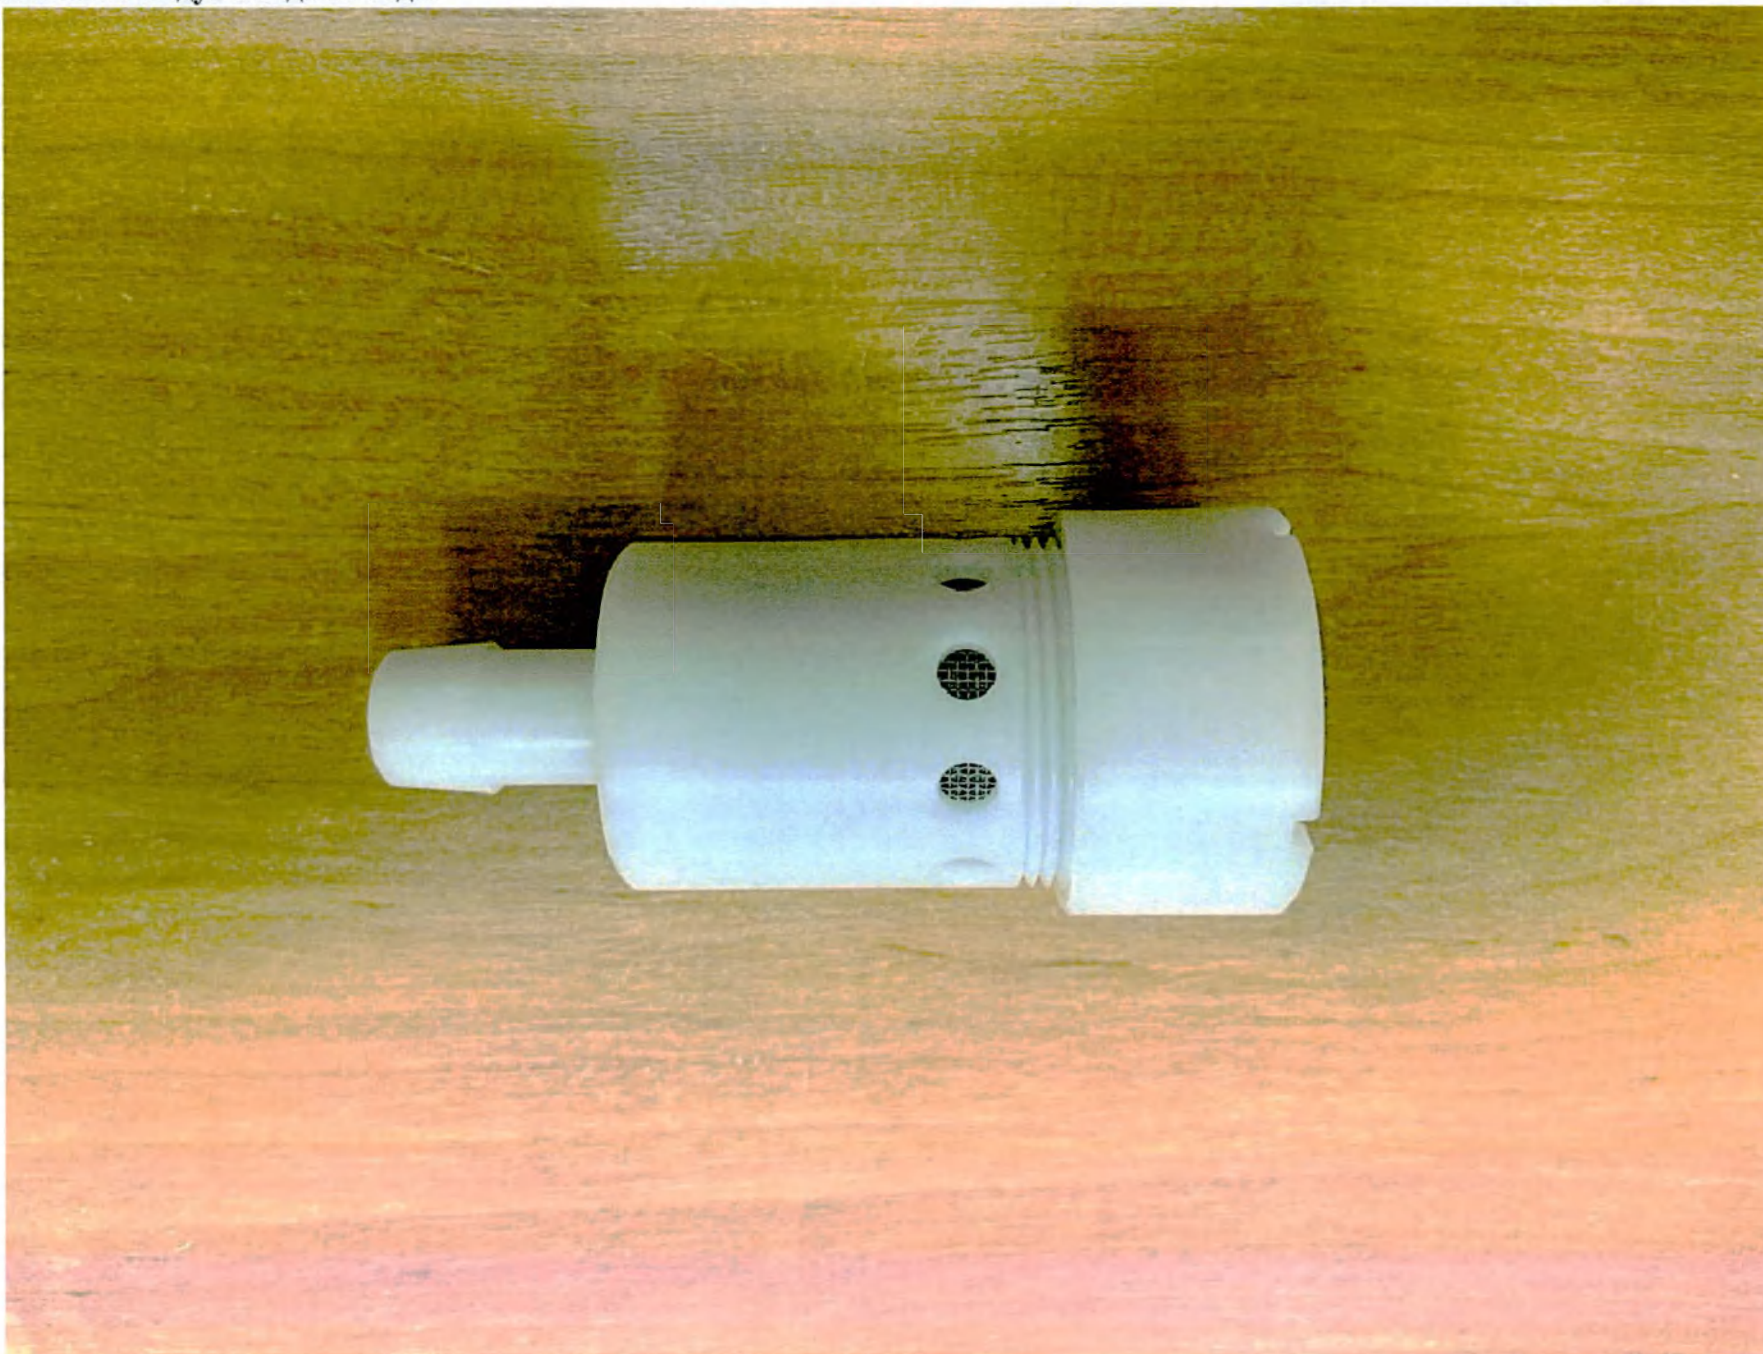


Входной фильтр для воды

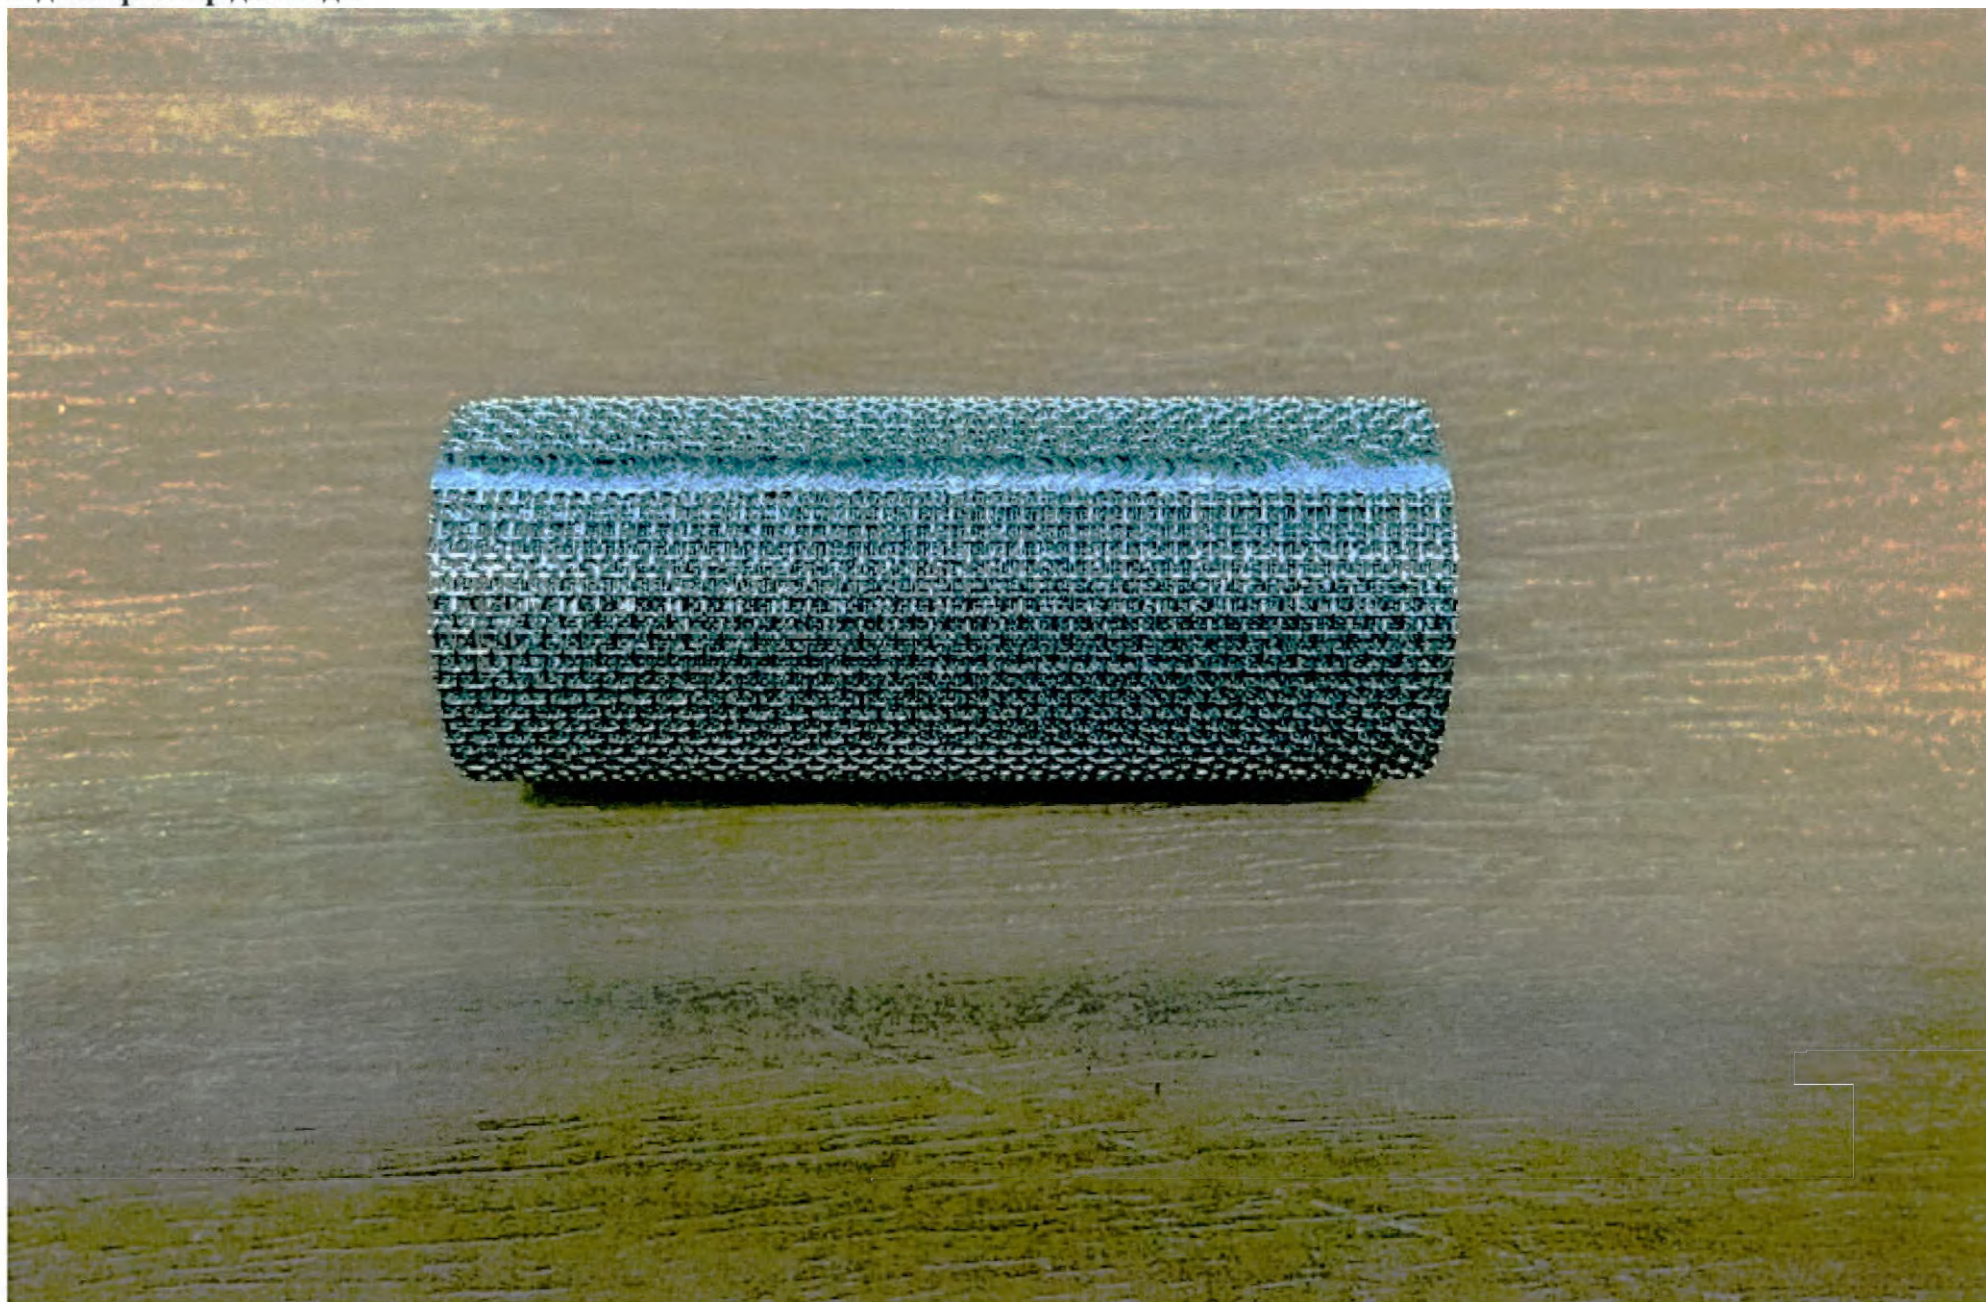

Инструмент для открывания крышек

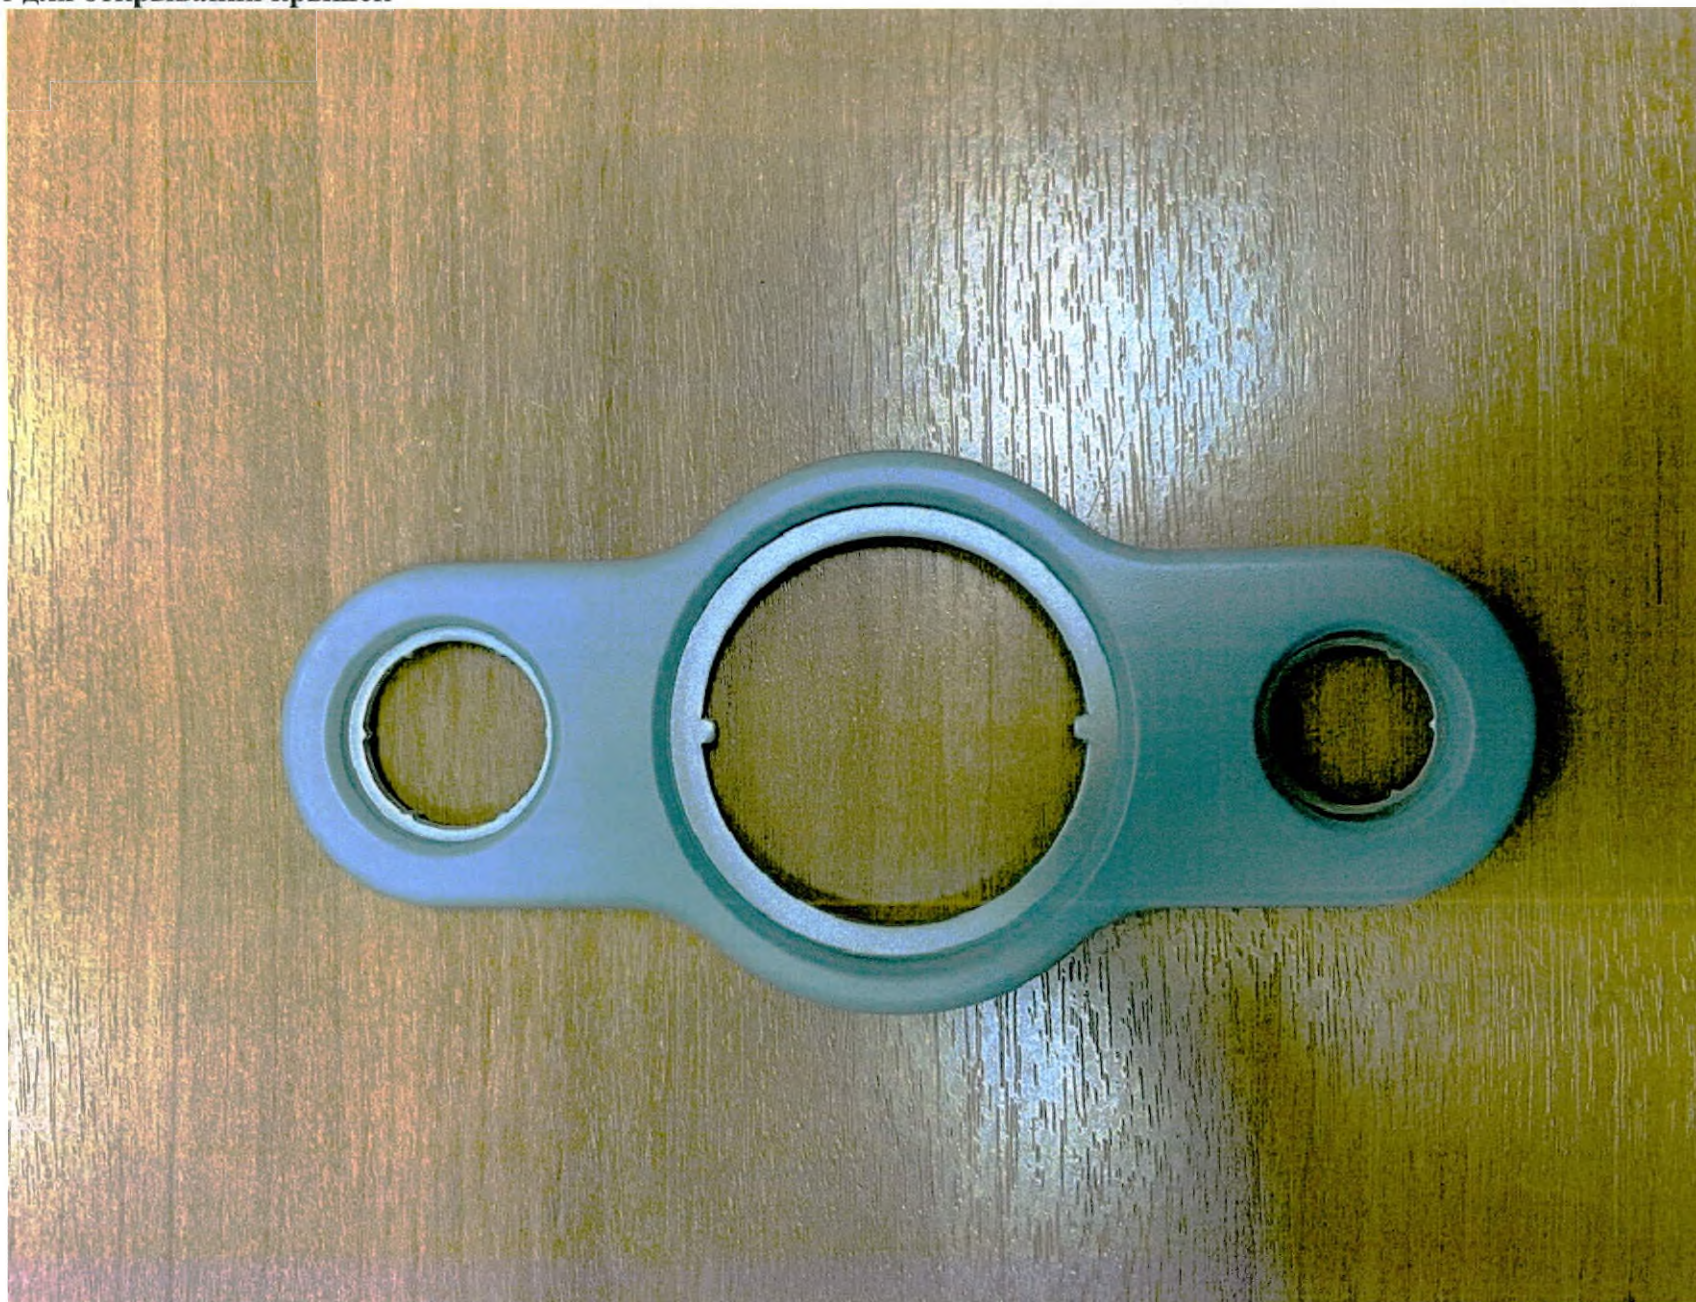

Инструмент для промывки дозатора для реагентов R1

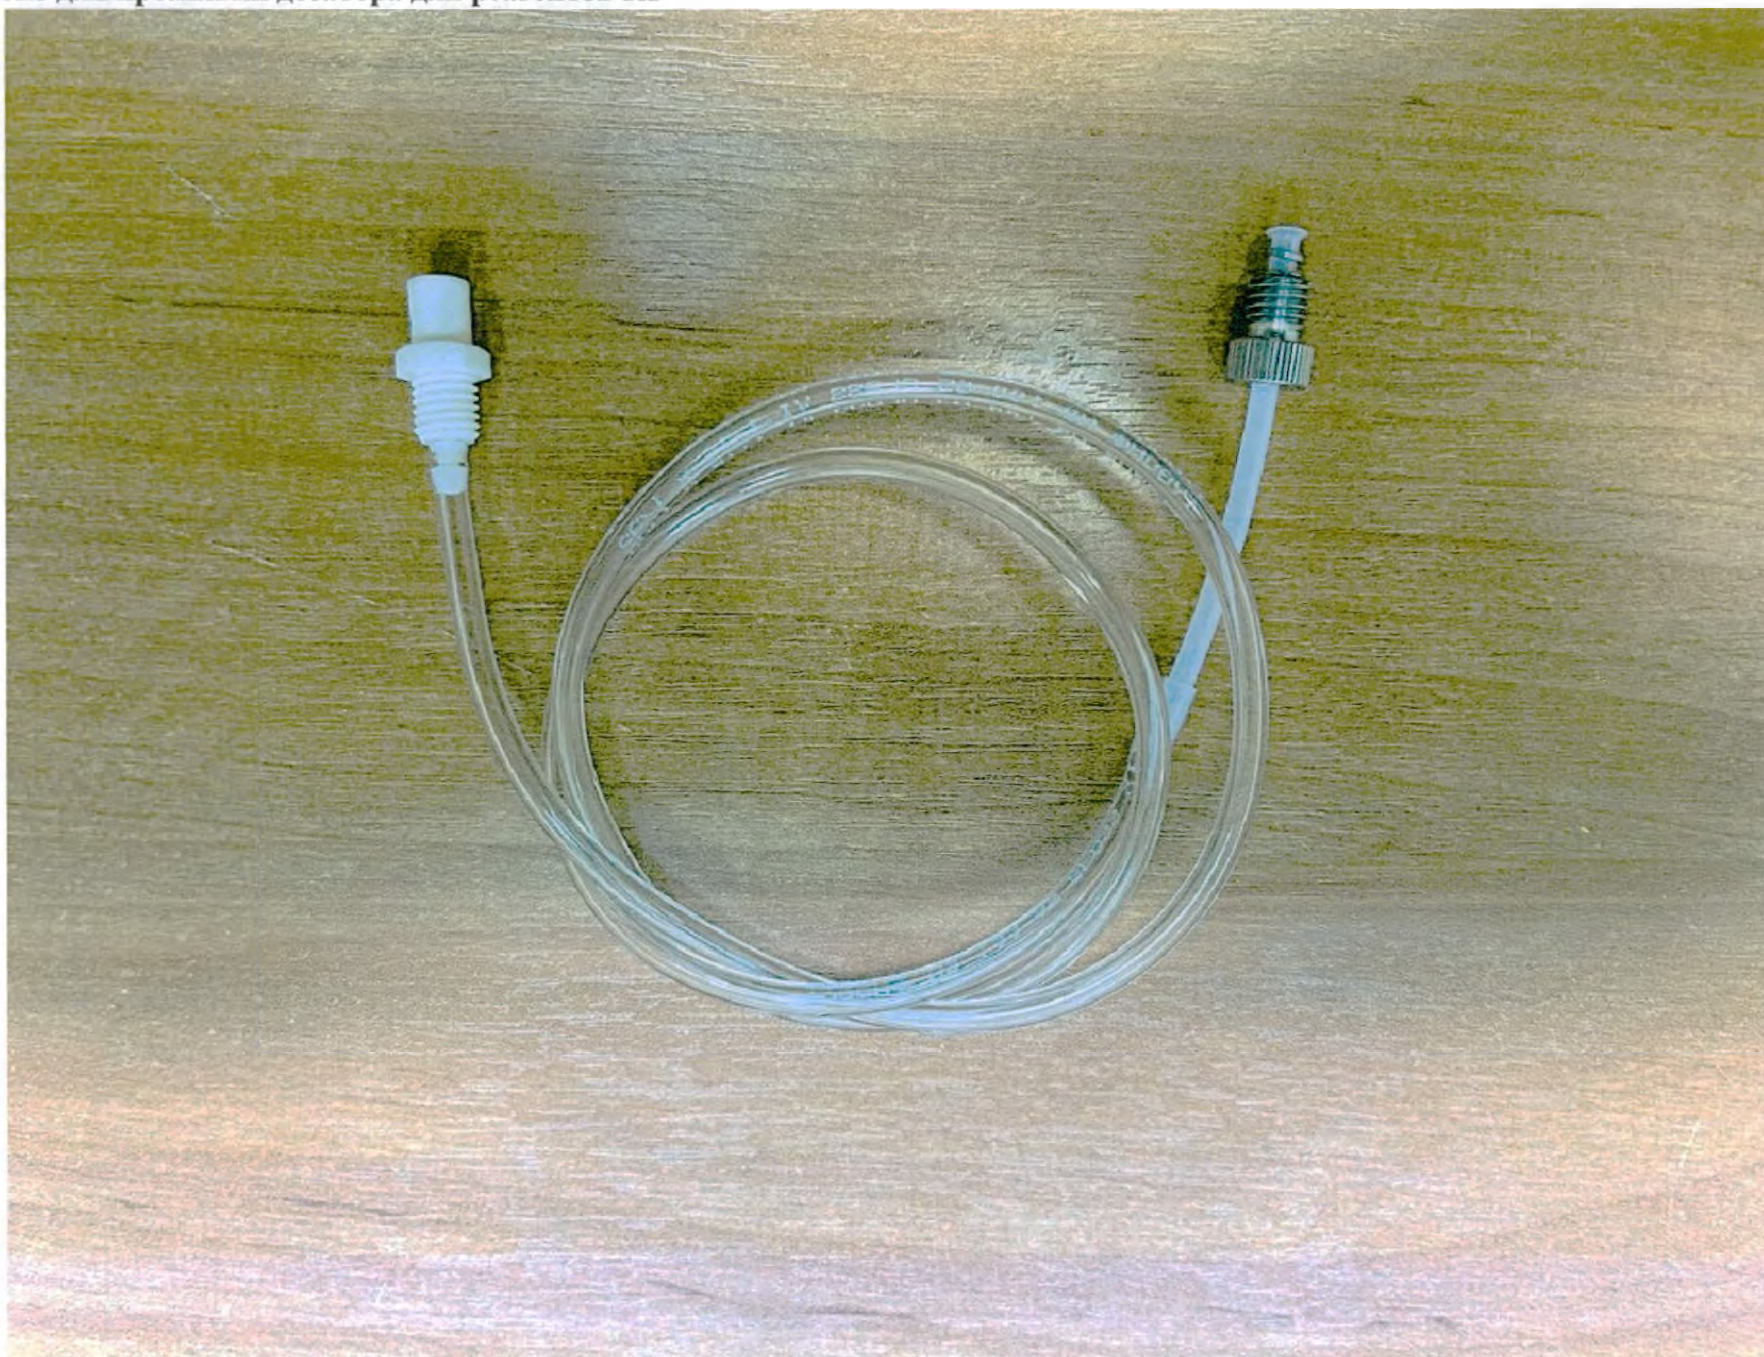


Инструмент для промывки пробоотборника и дозатора для реагентов R2



Инструмент для очистки пробоотборника



Крестовая отвертка

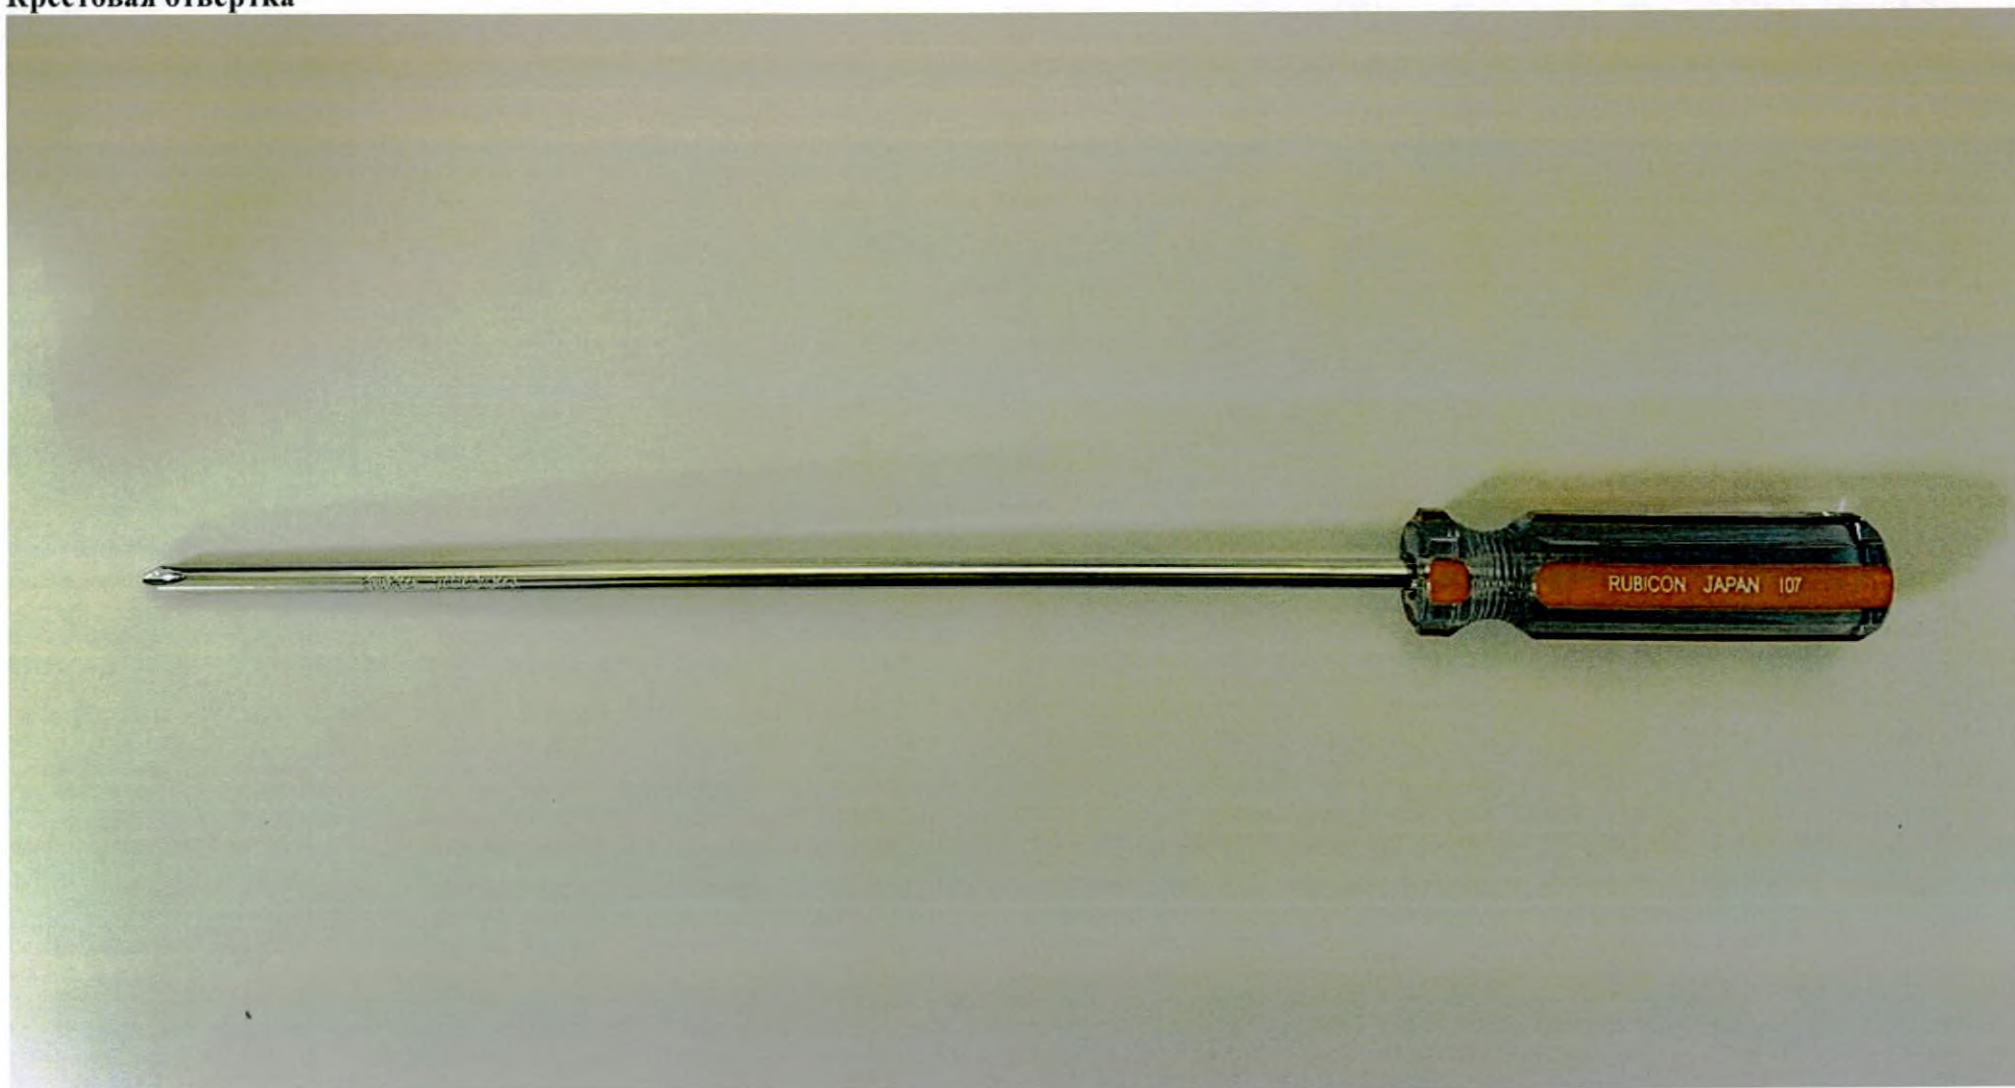


Плоская отвертка



Ключ шестигранный




Прокладка для пробоотборника

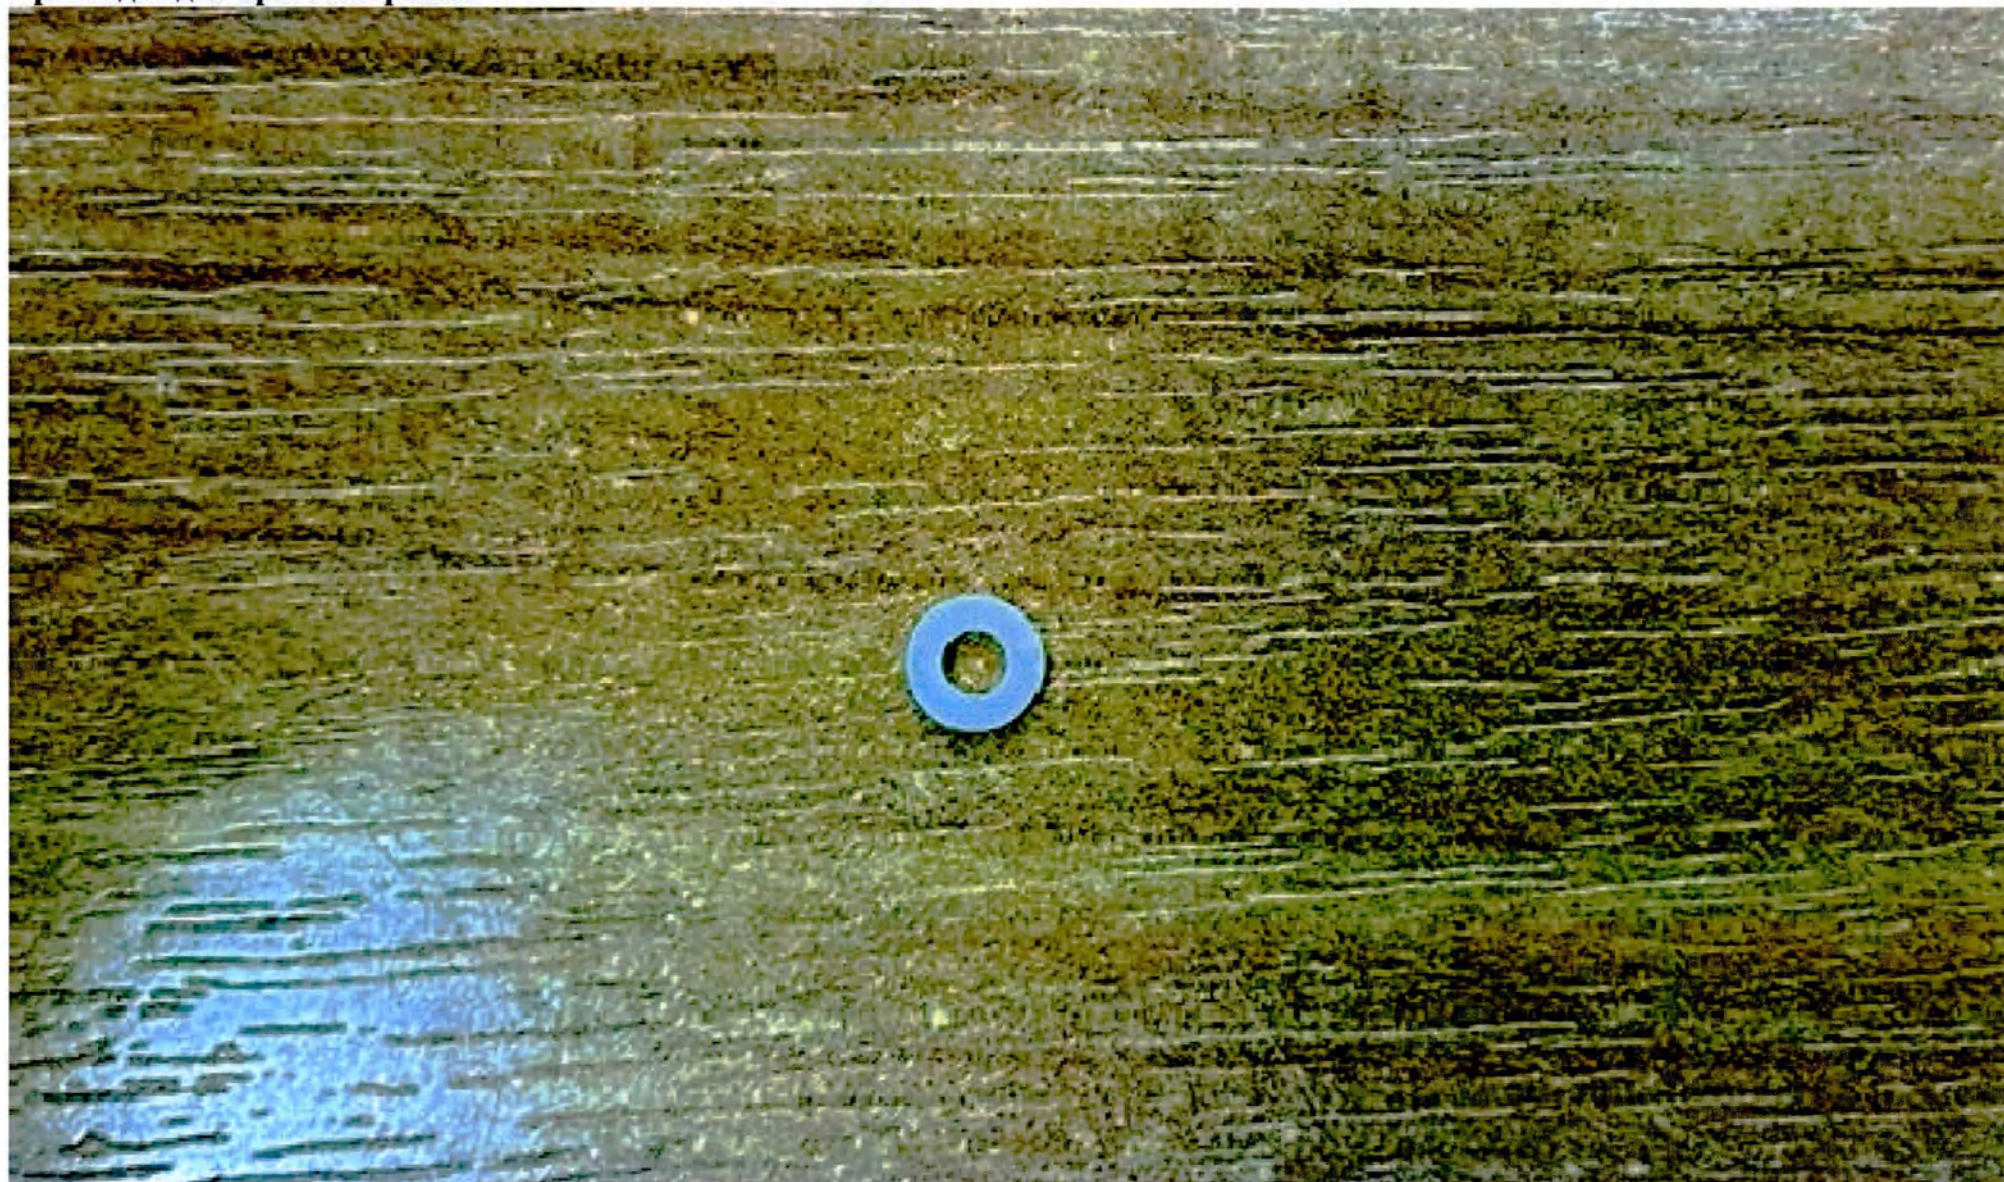


Коннектор Y-образный




Коннектор быстросъемный пневматический

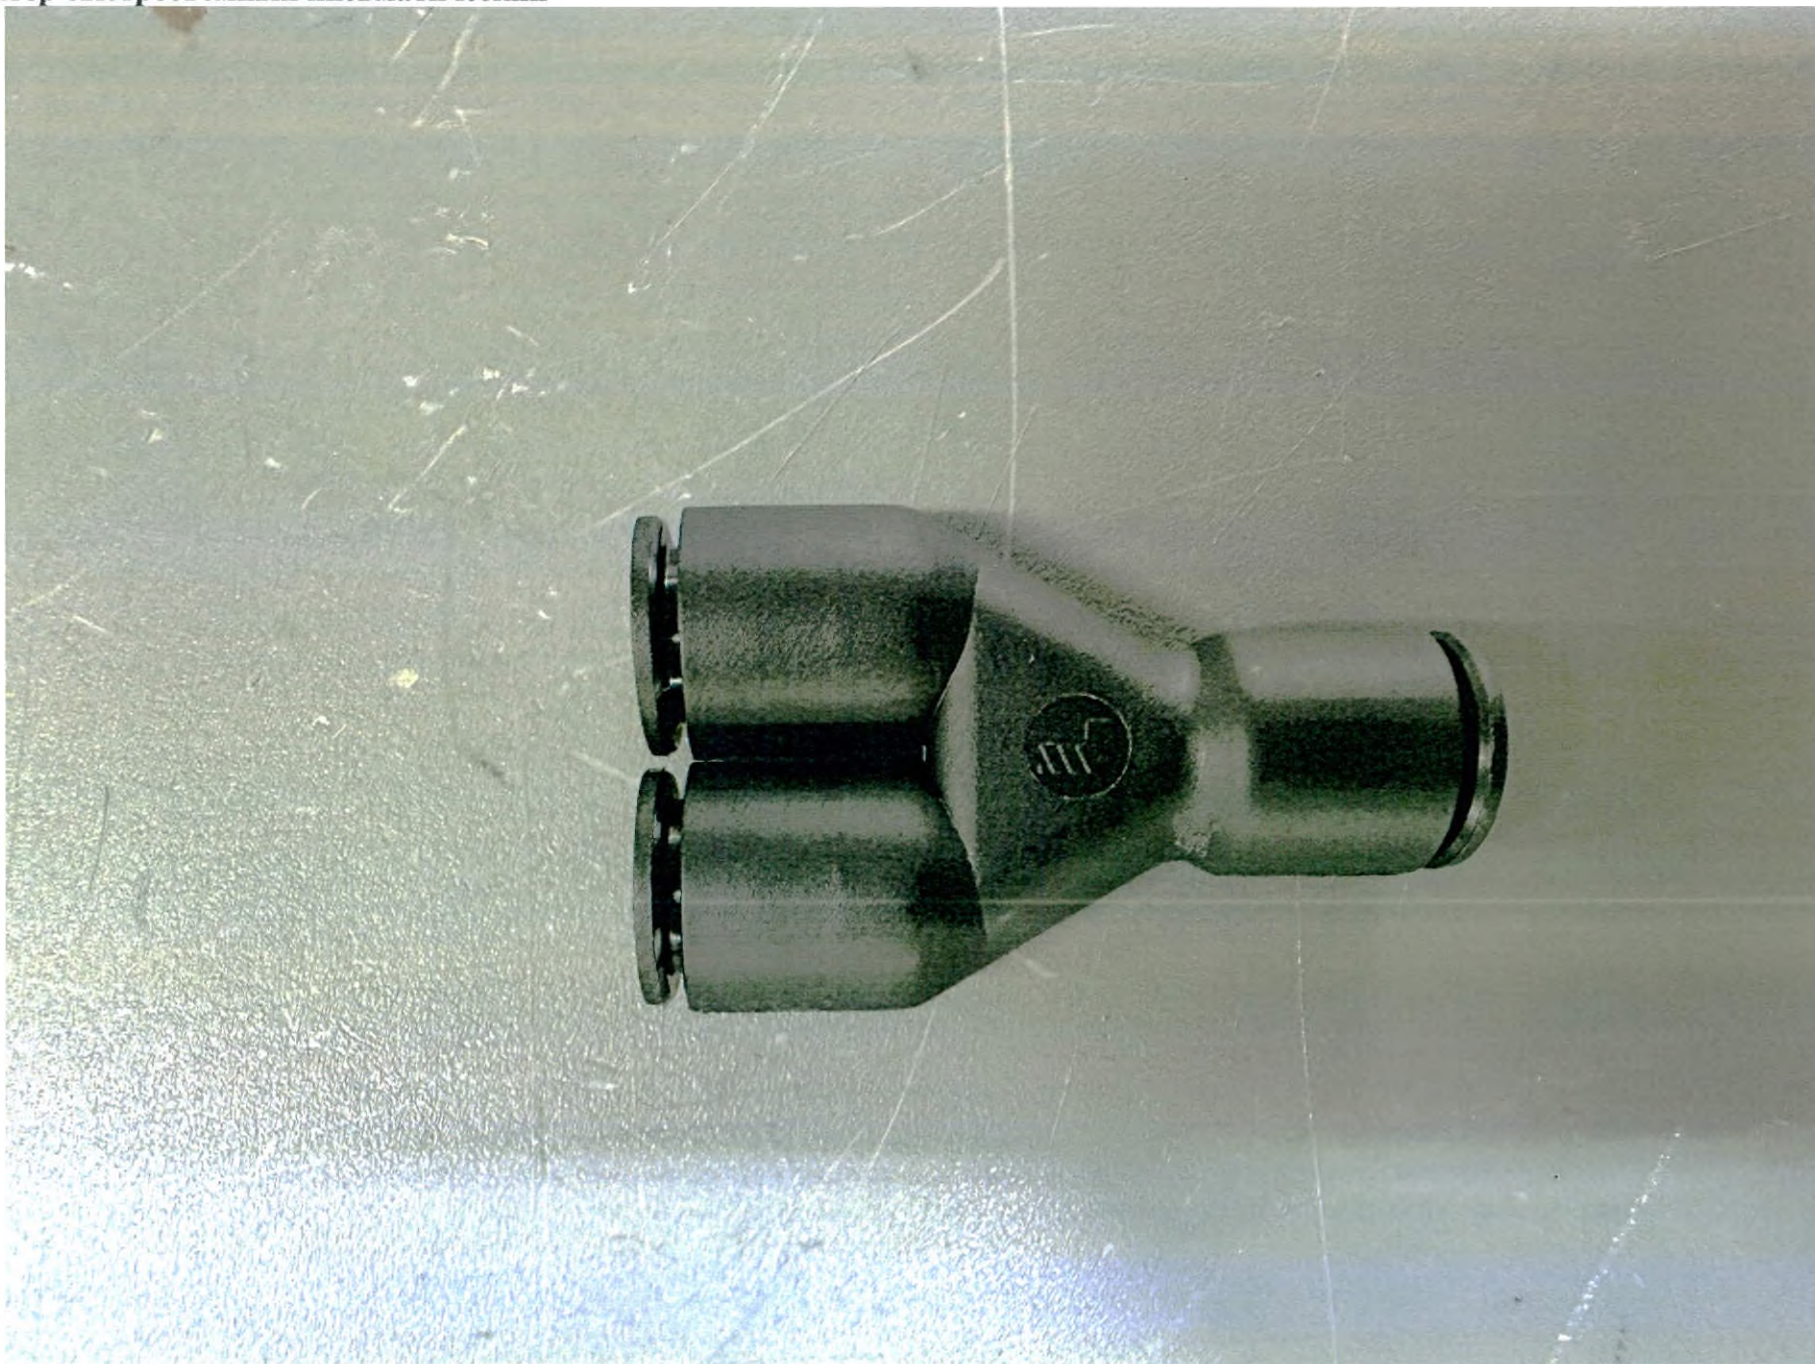

Переходник, 10 мм

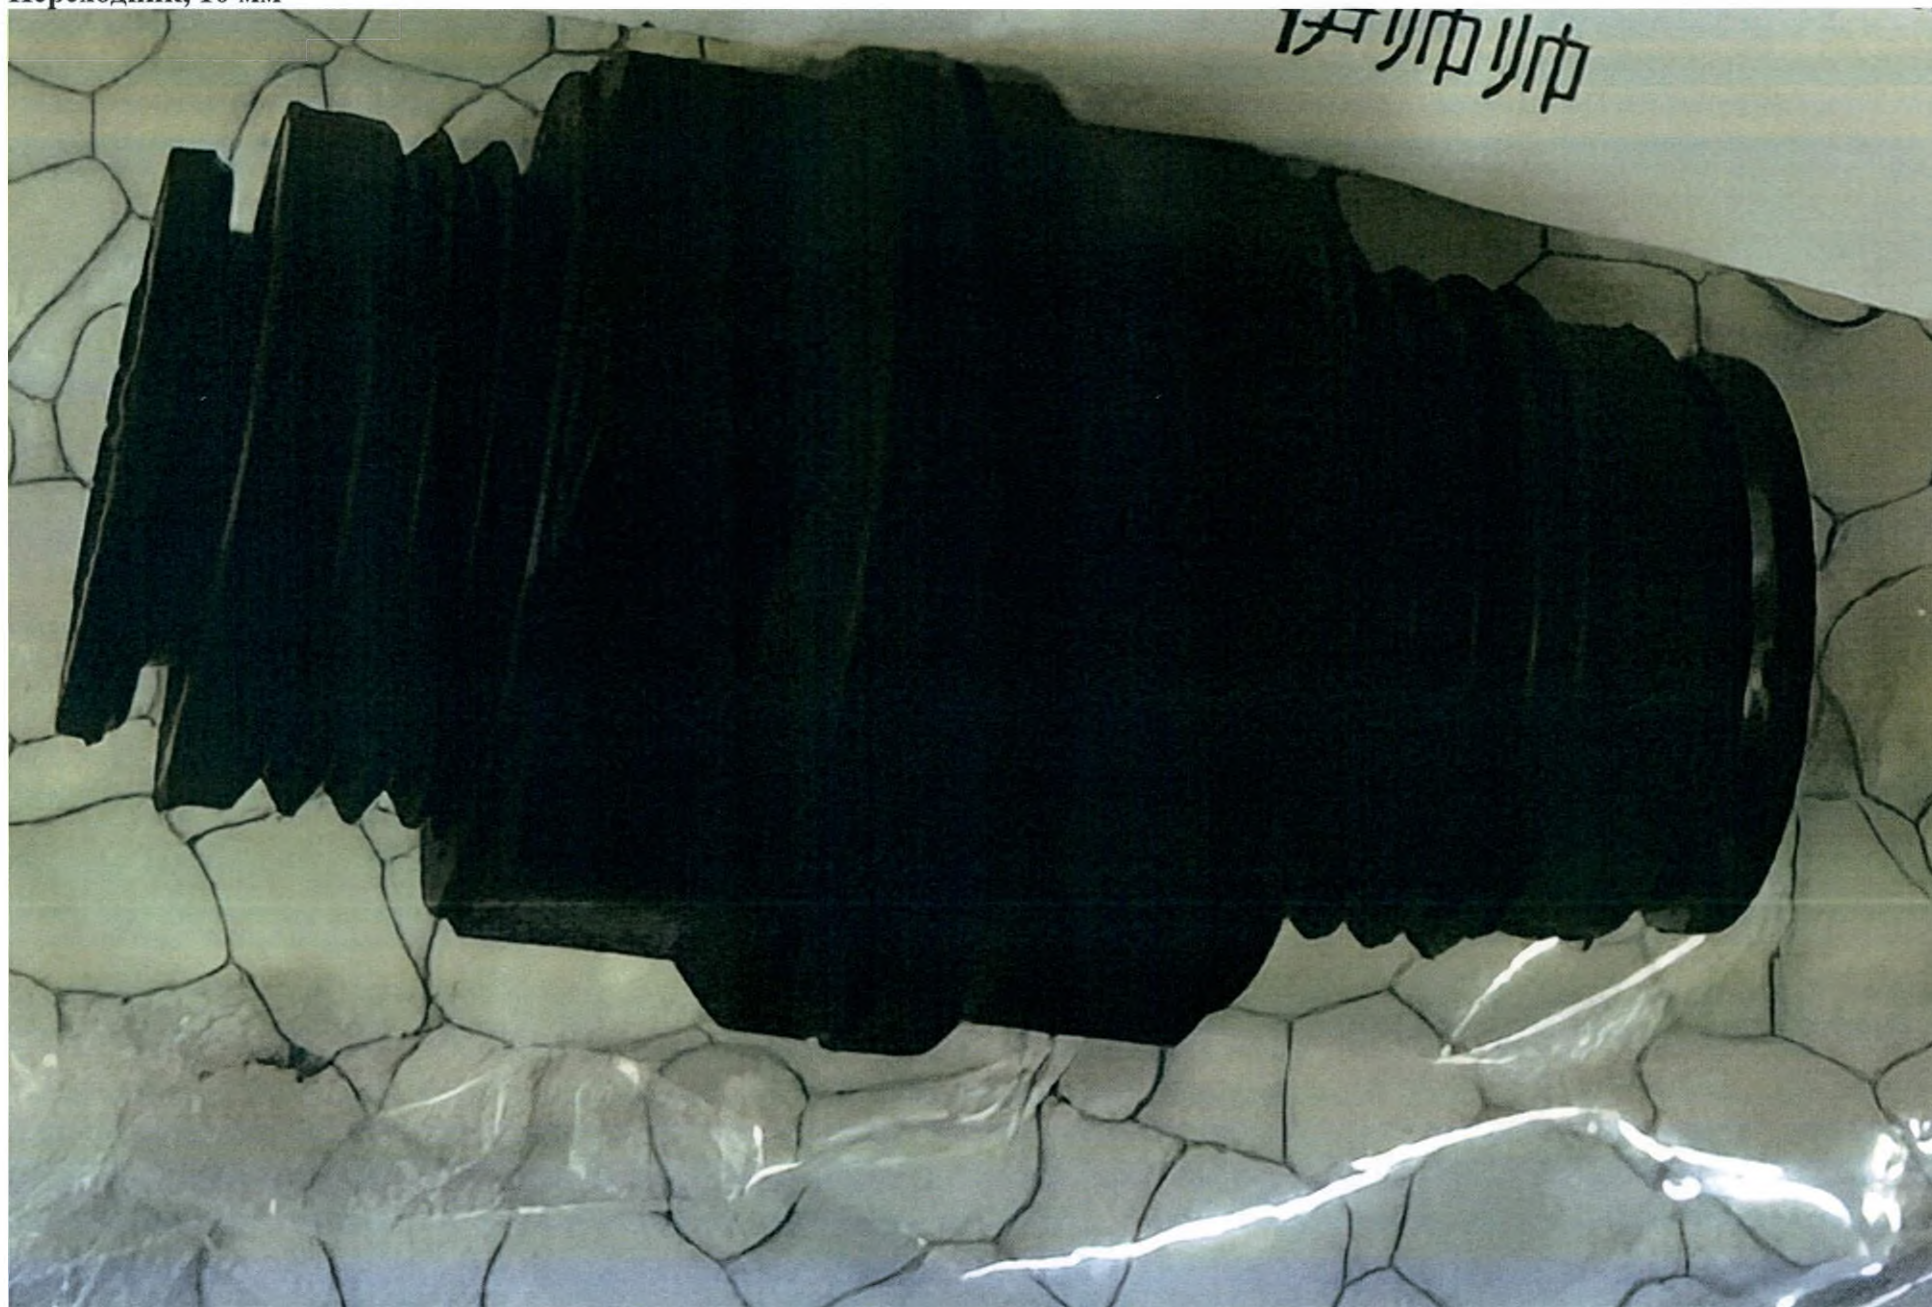


Хомут фиксирующий полимерный

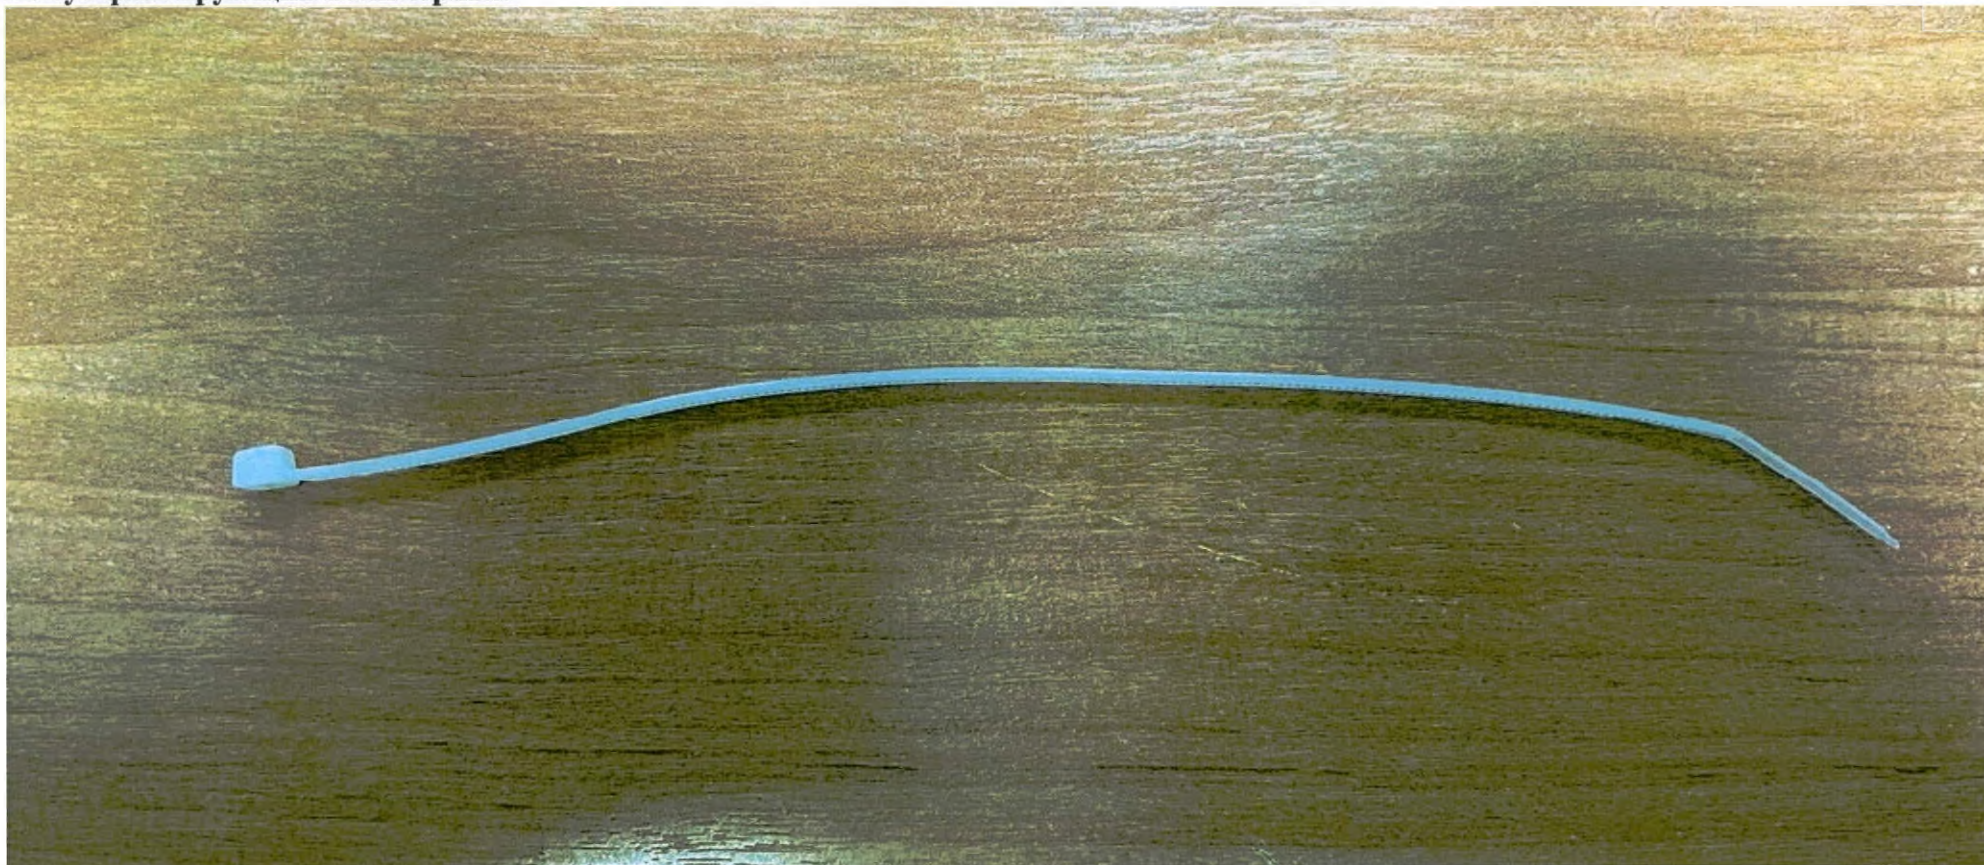


Хомут фиксирующий металлический



Заглушка вентиляционного отверстия модуля ISE

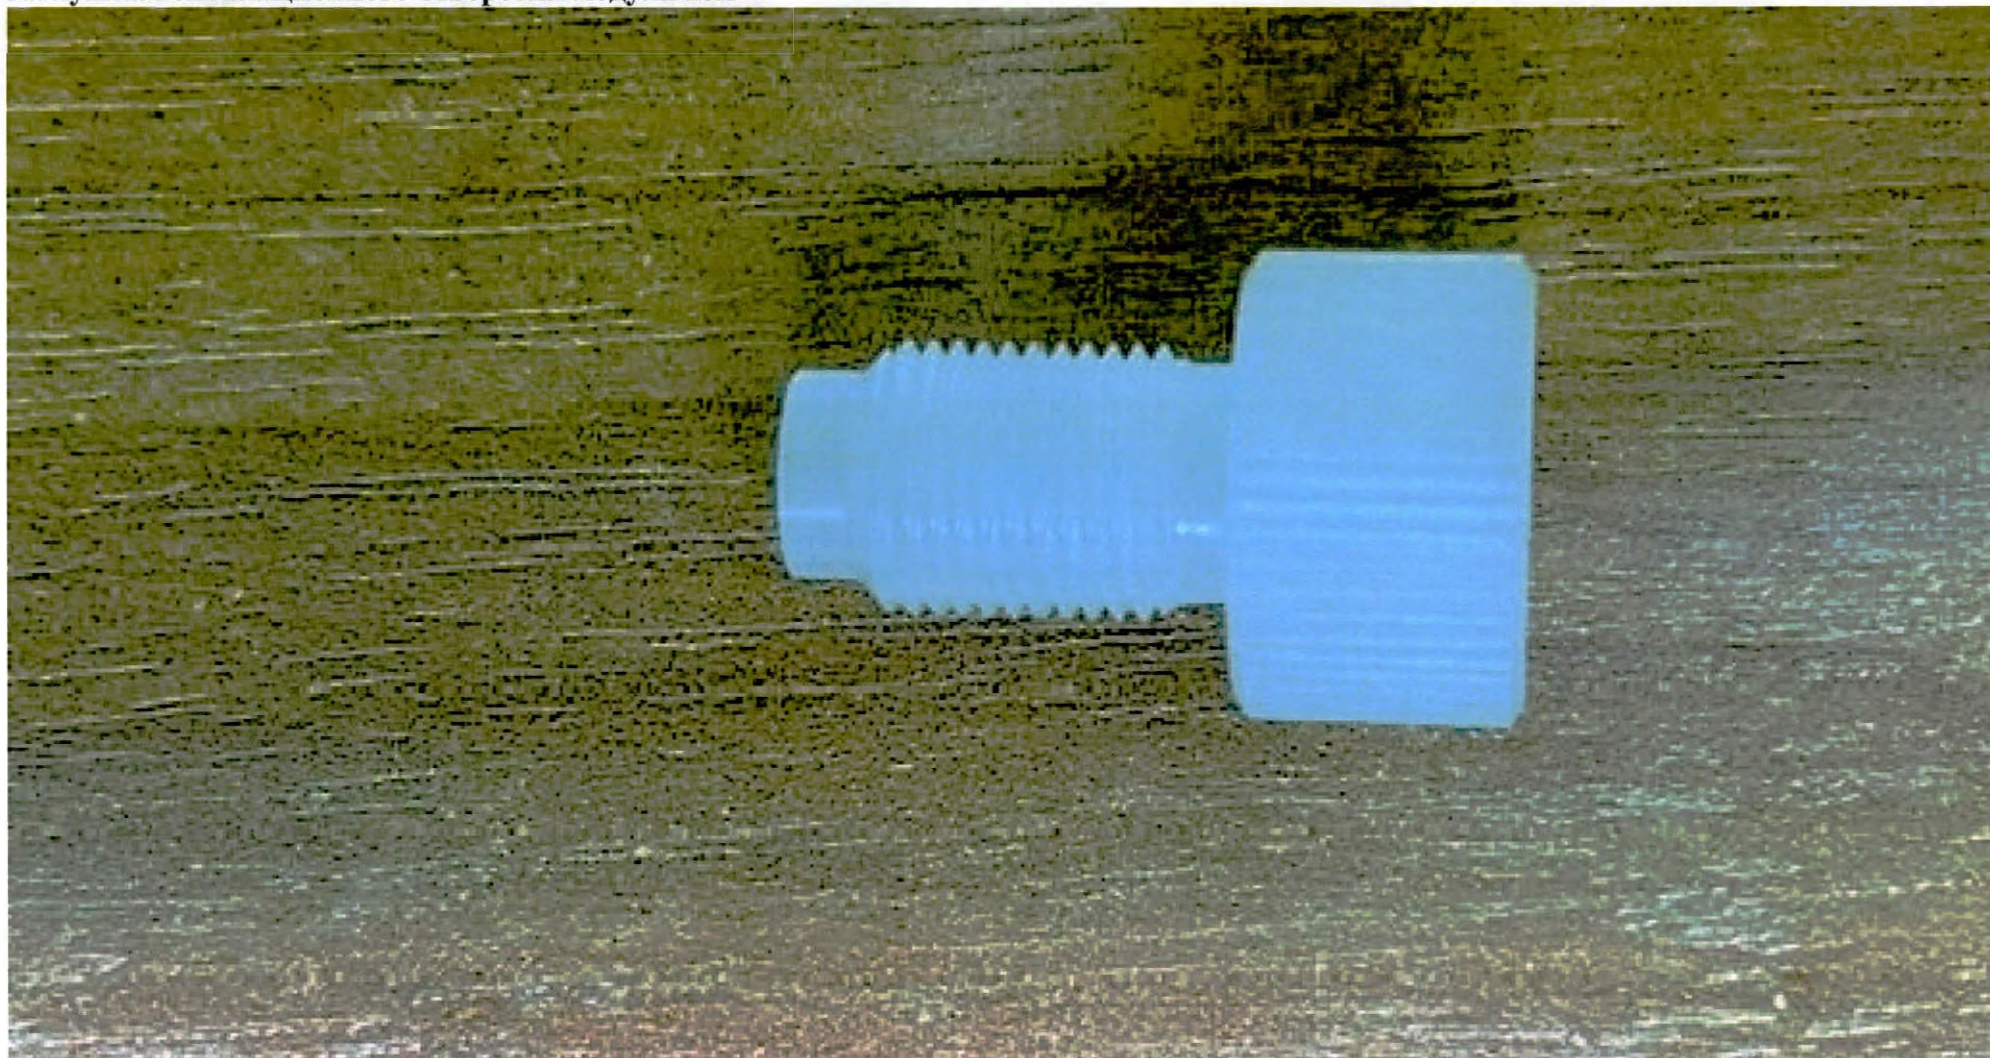

Пластиковая заглушка для карусели реагентов

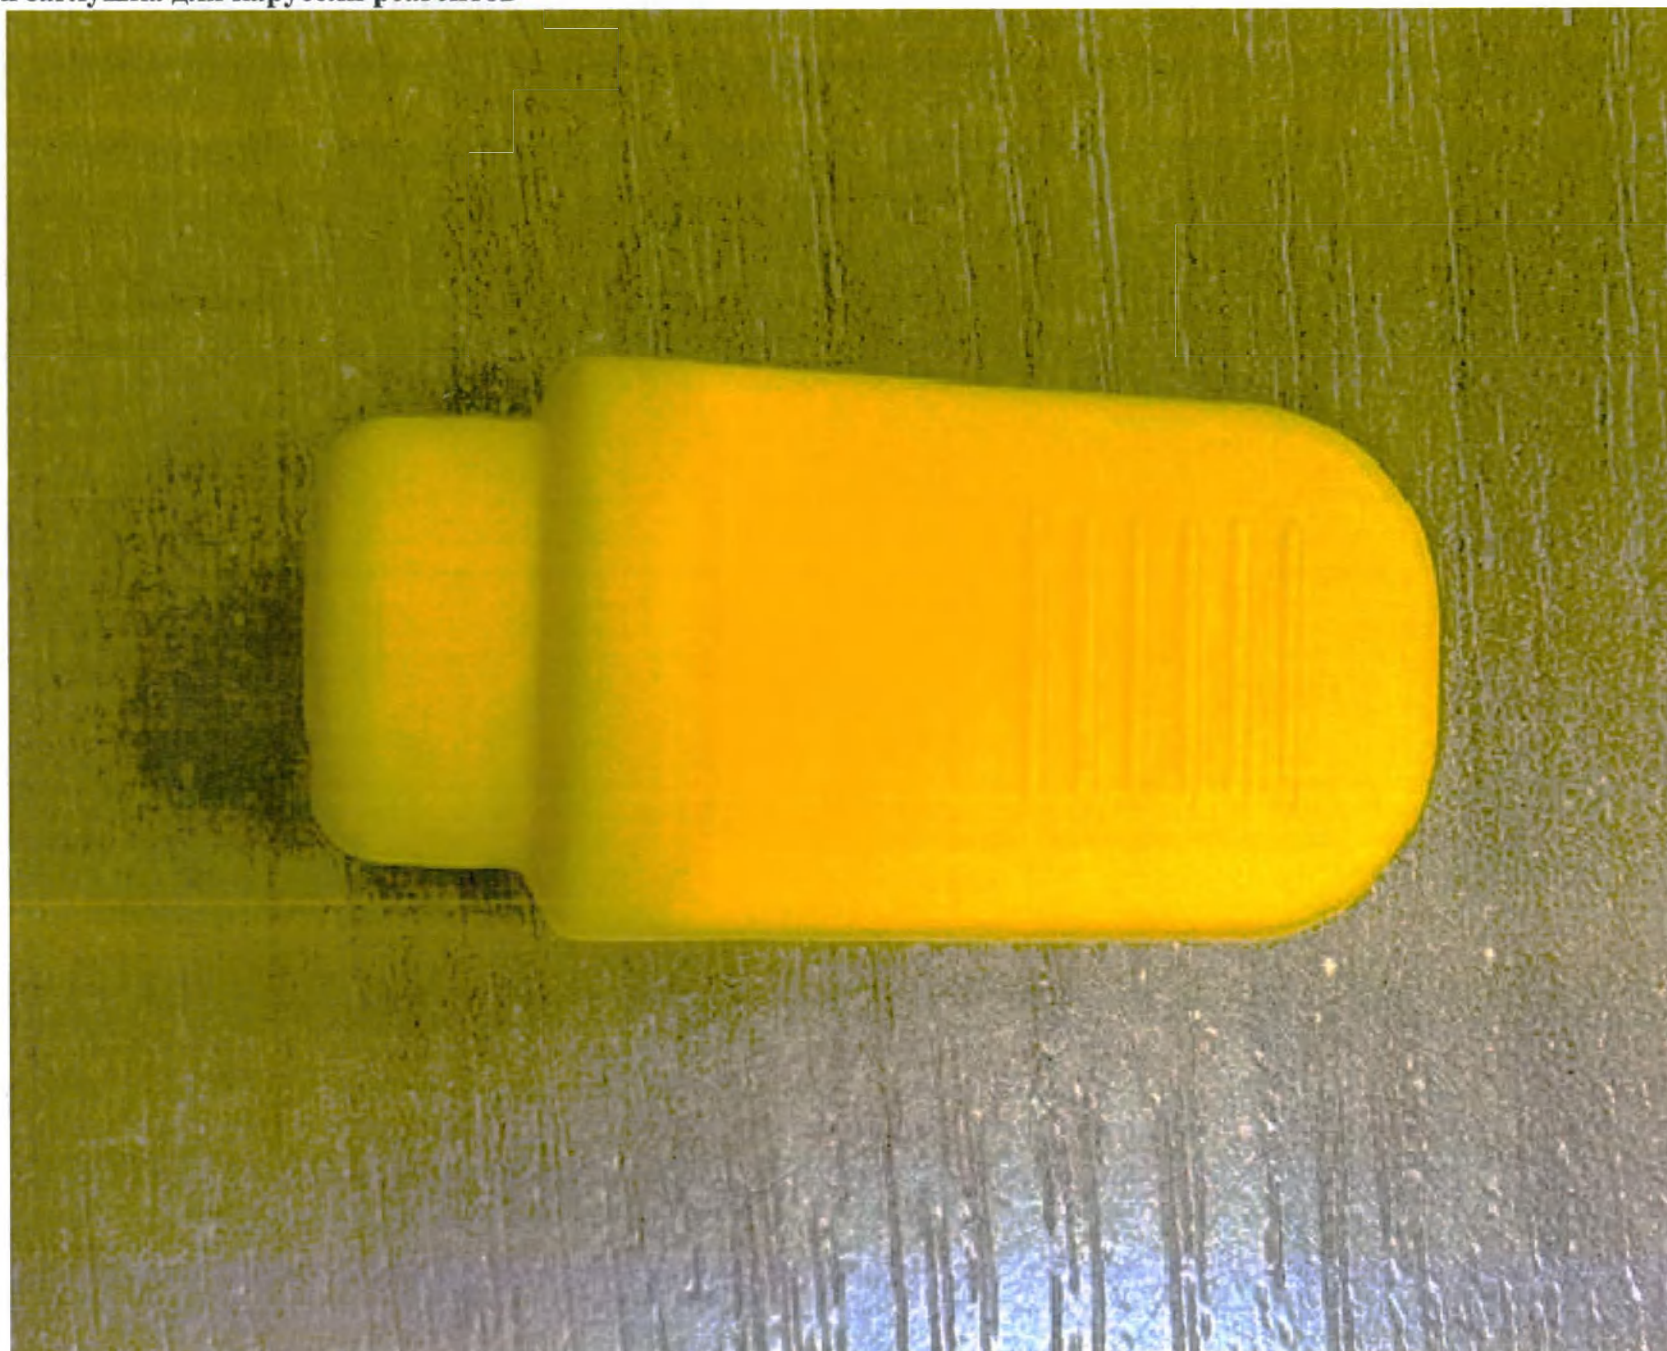

Резиновая заглушка для винта



Резиновая заглушка



Противоударная заглушка



Шайба пружинная



Шайба плоская М8



Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х8





Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х6




Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х12



Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М3Х12

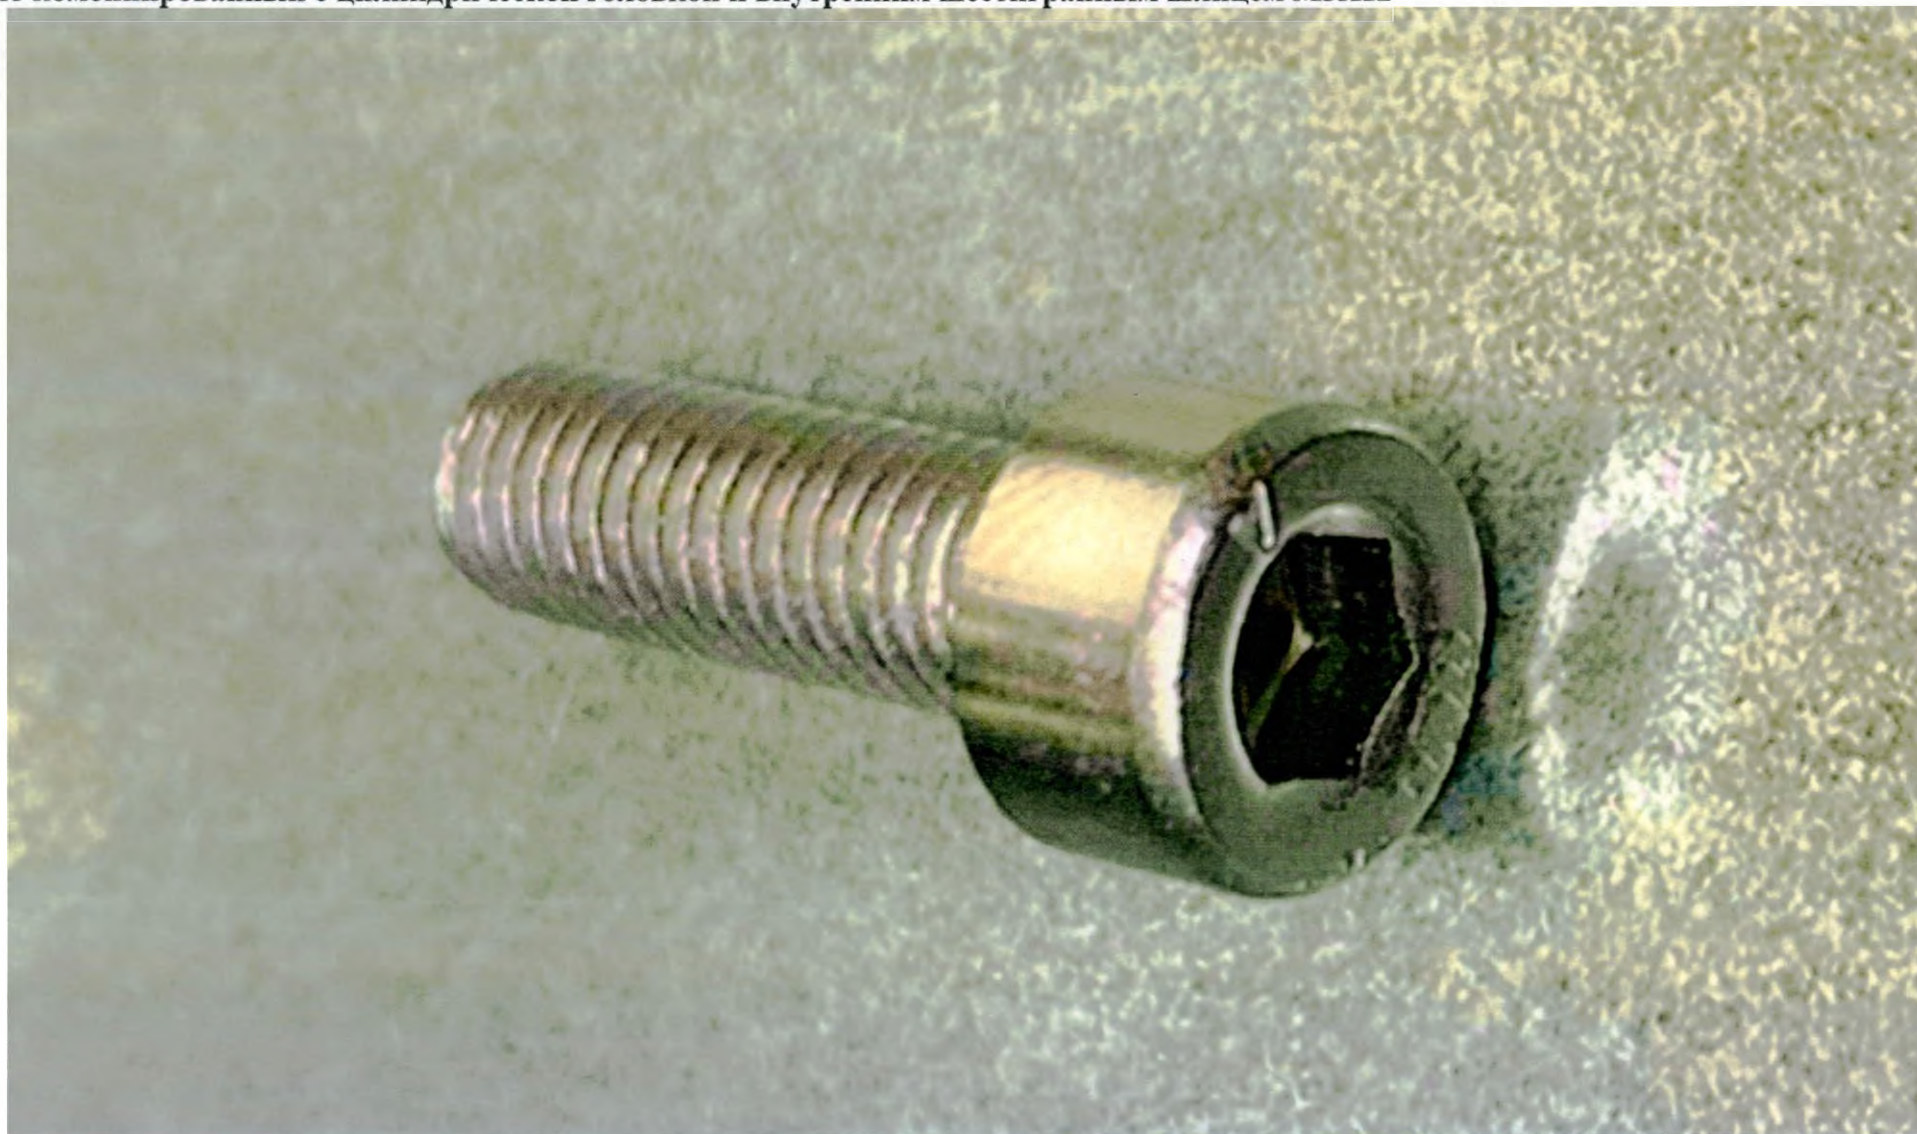

Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М6Х16



Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х14




Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М8Х50




Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M8X20




Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M5X12

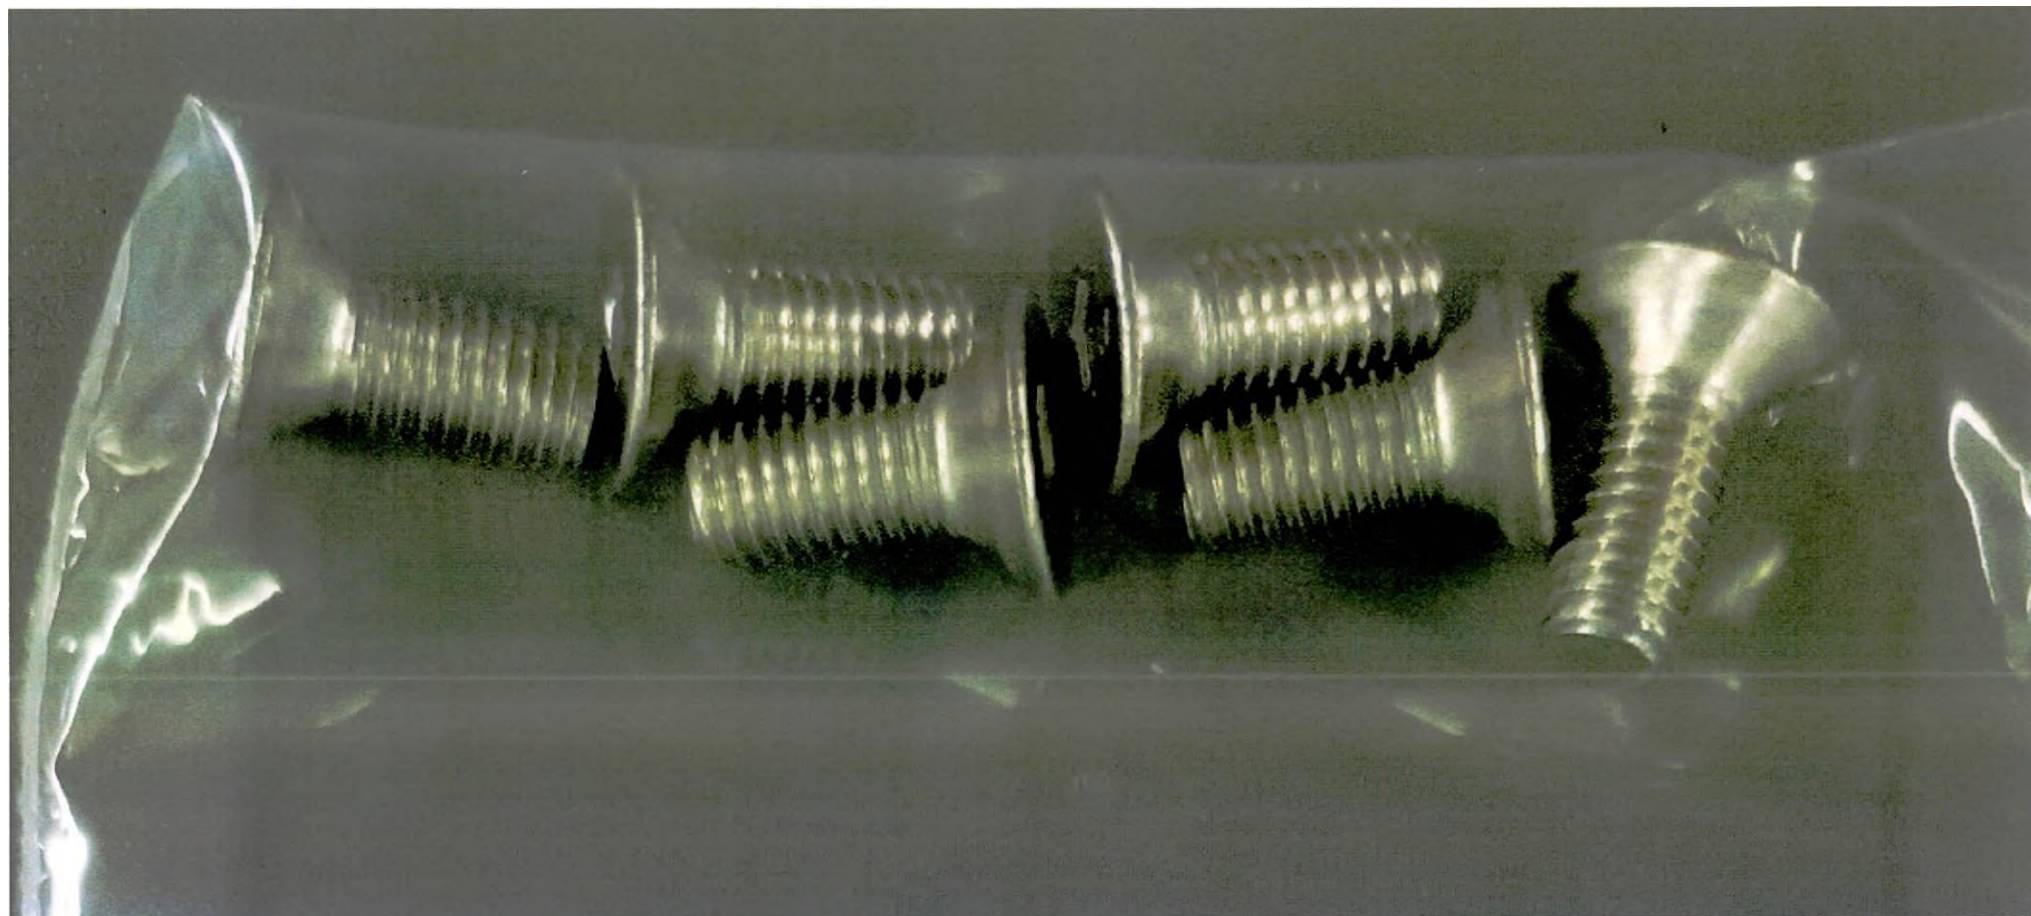


Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М6Х16

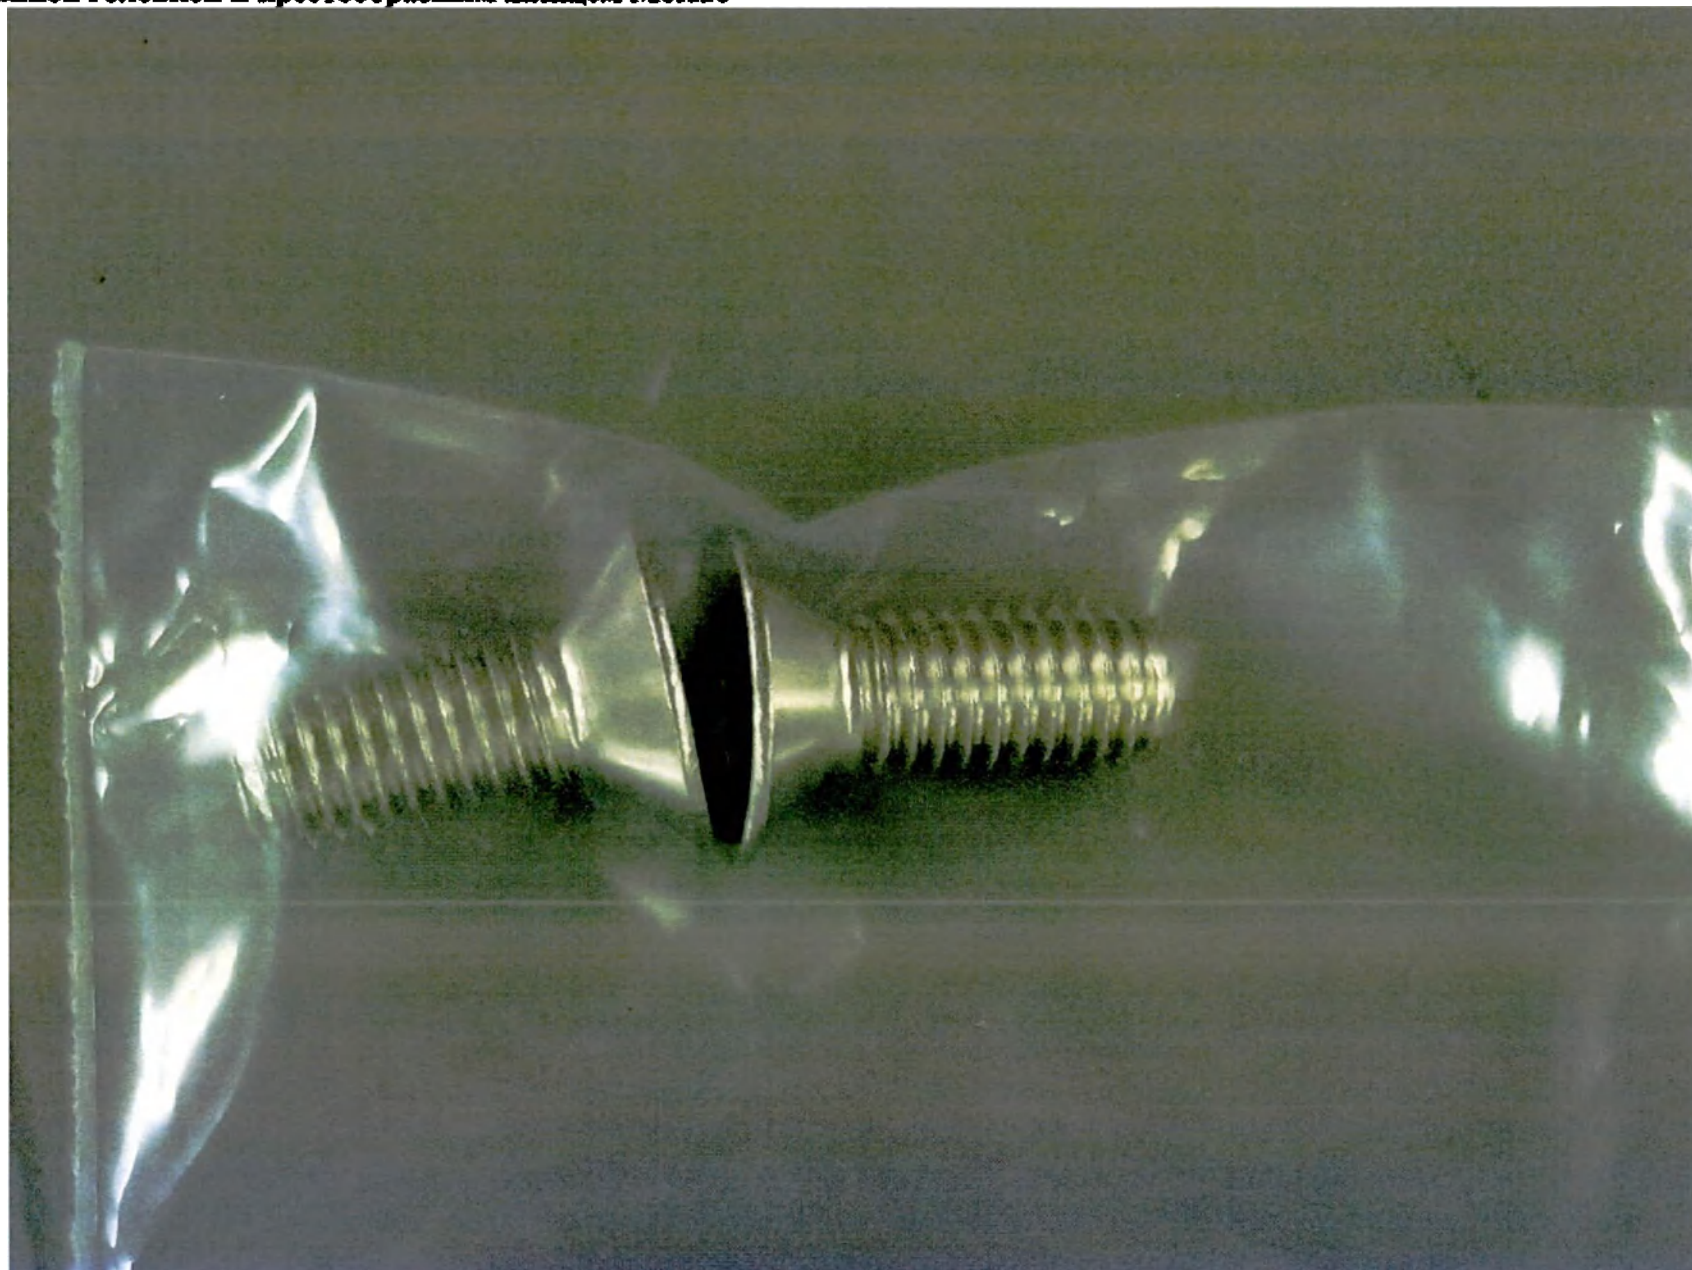


Кронштейн соединительный

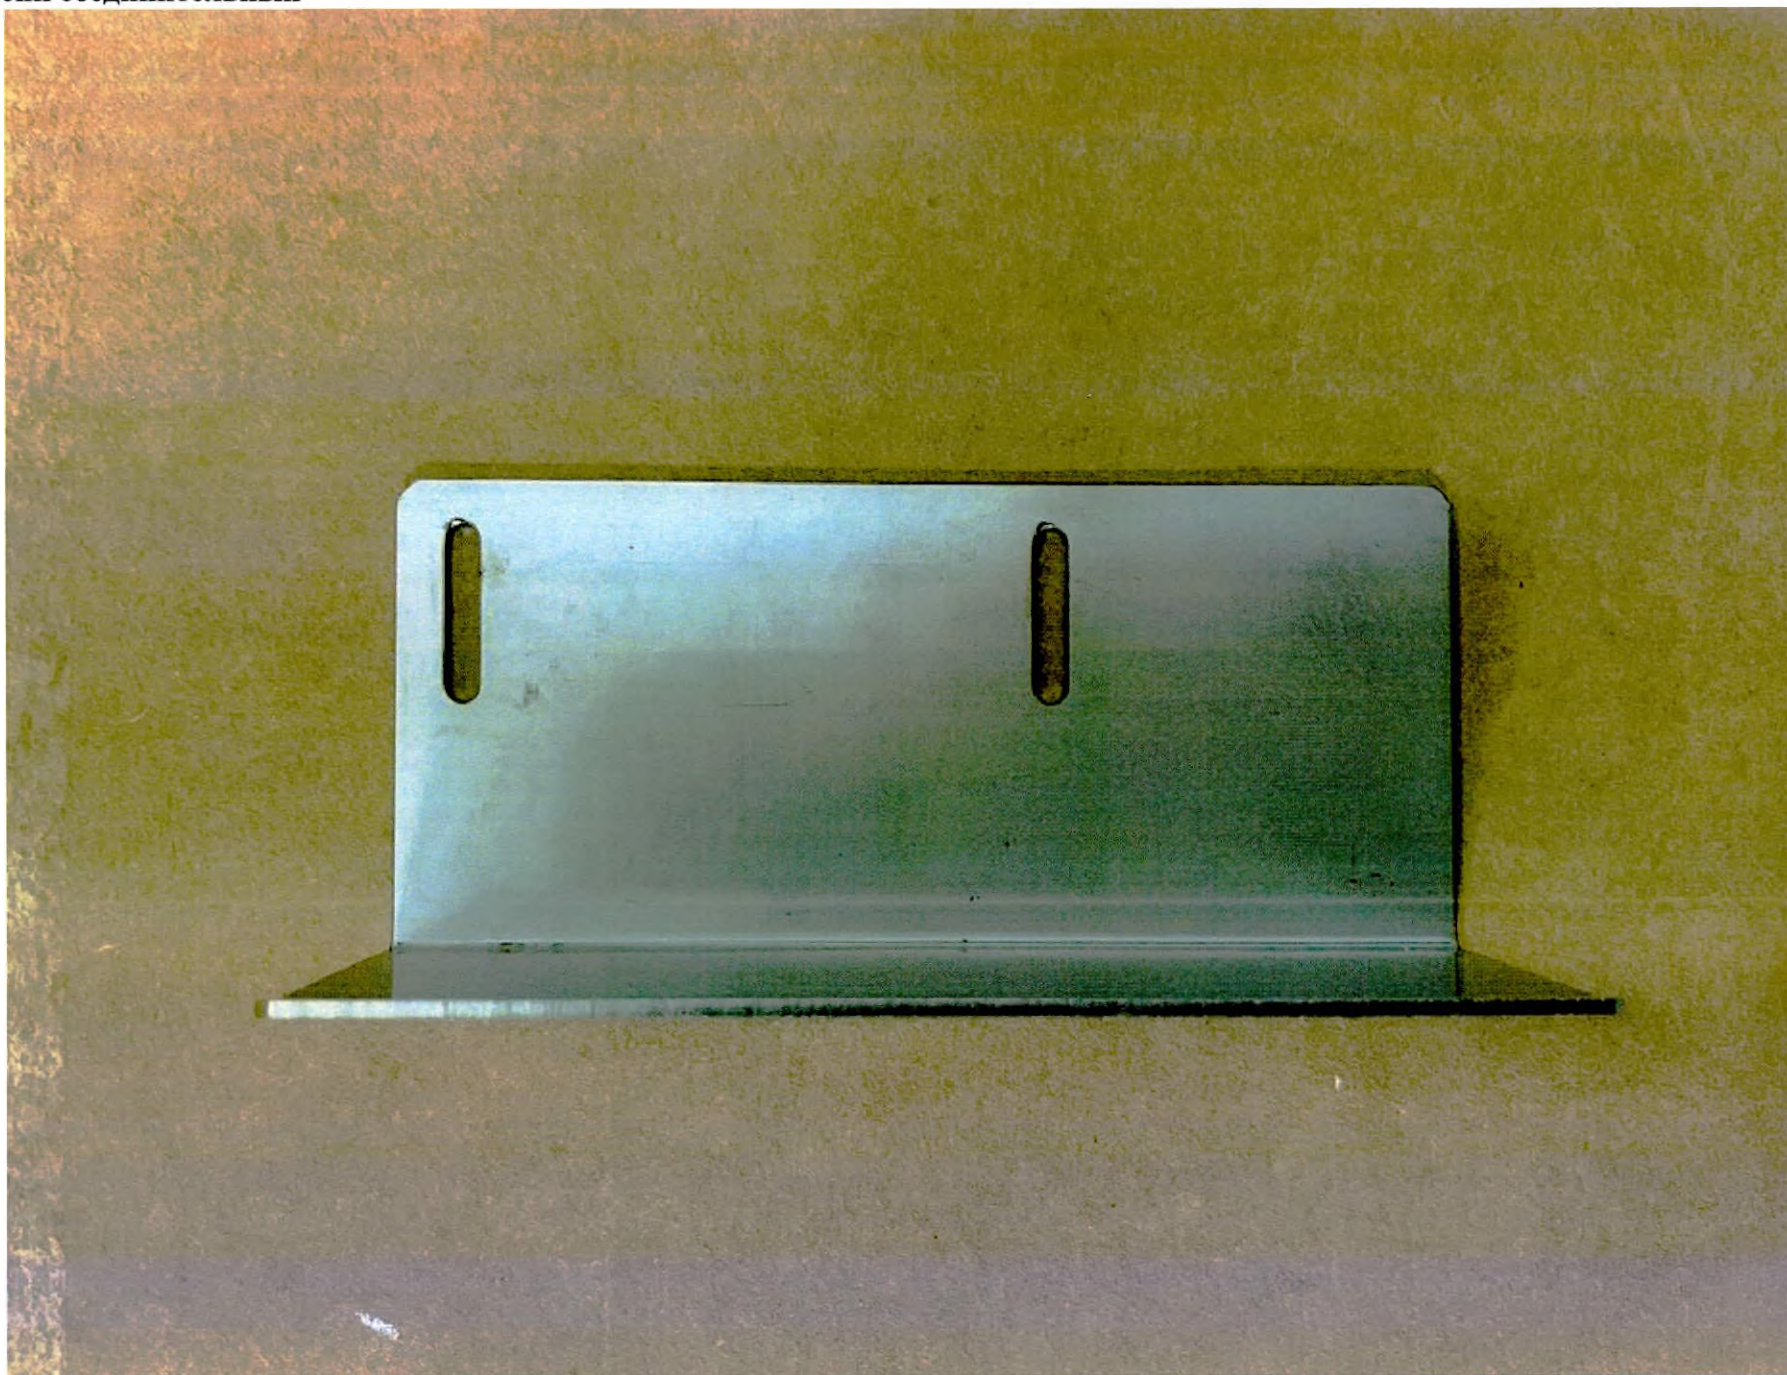


Фиксатор для проводов

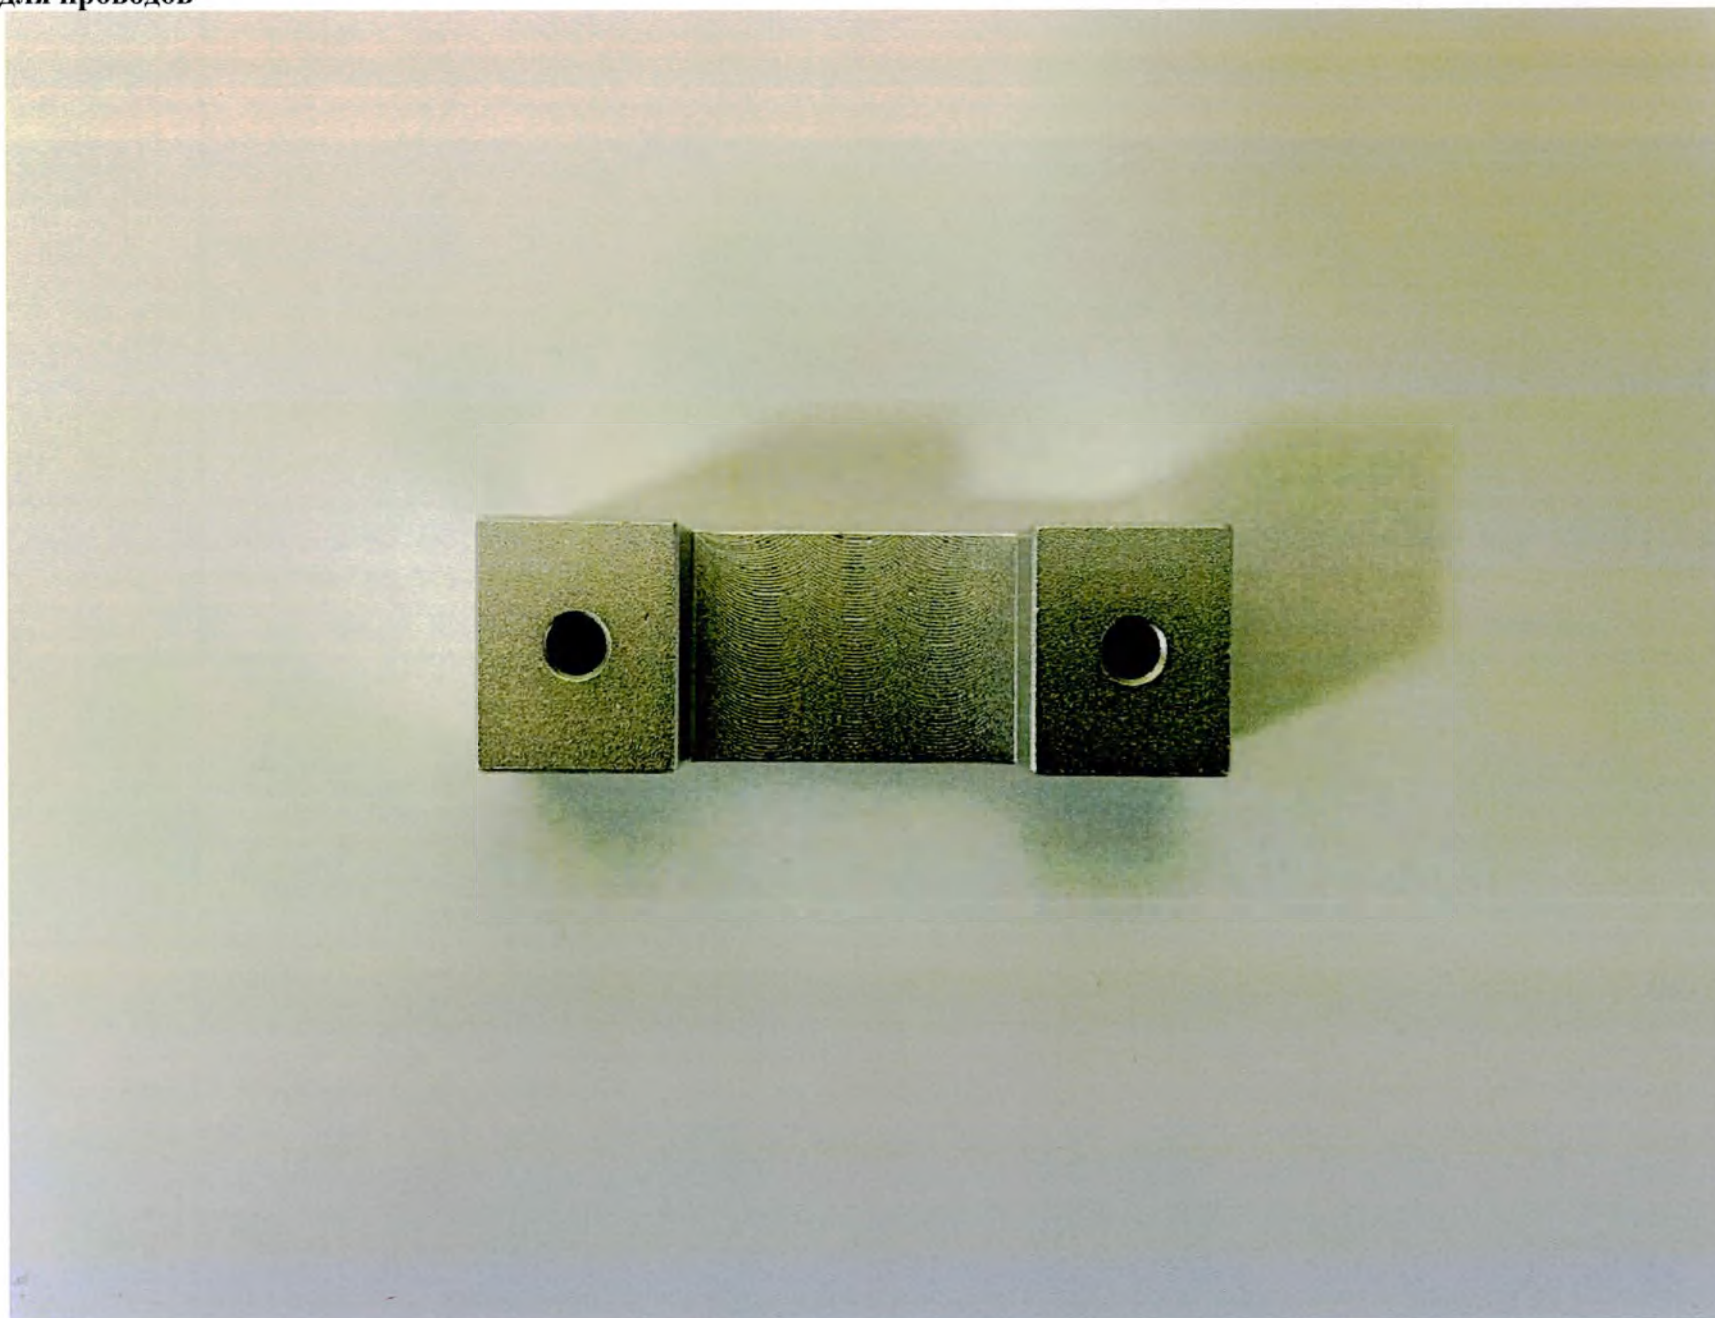

Трубка пневматическая 4.0 x 6.0 мм

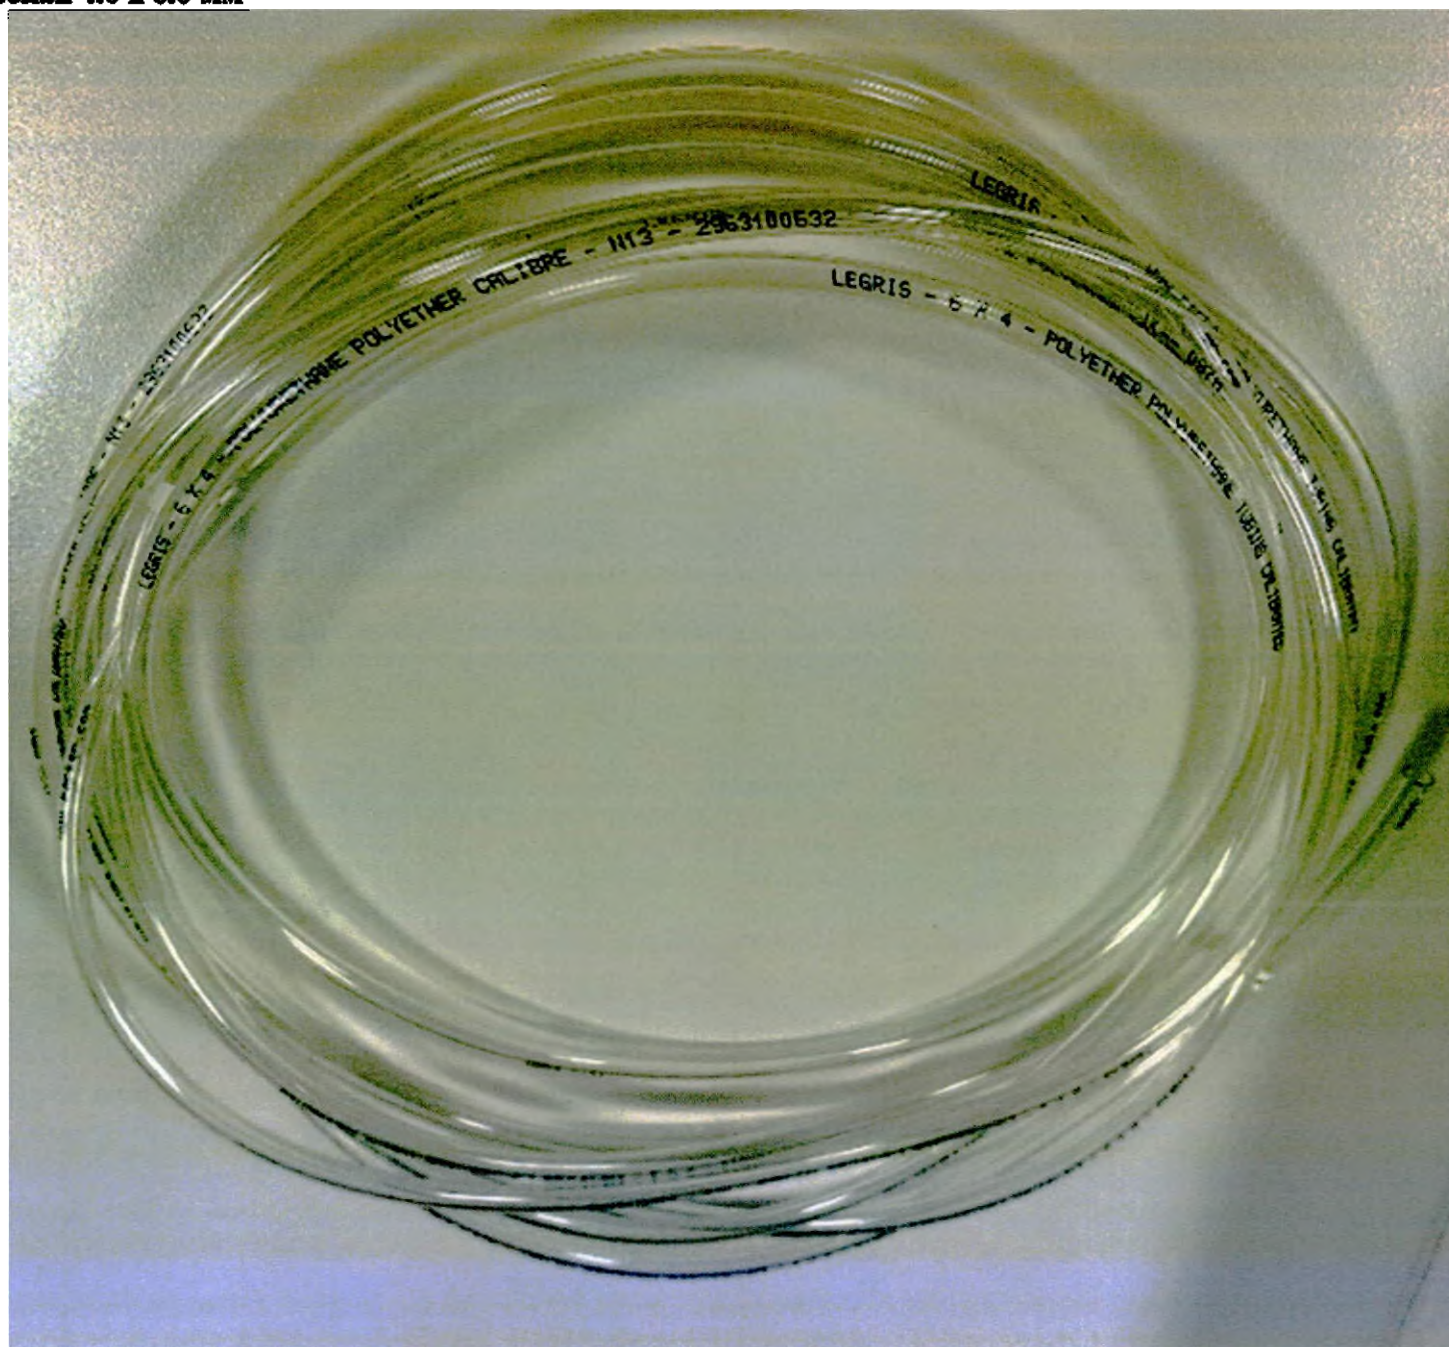


Трубка пневматическая 7.0 x 10.0 мм

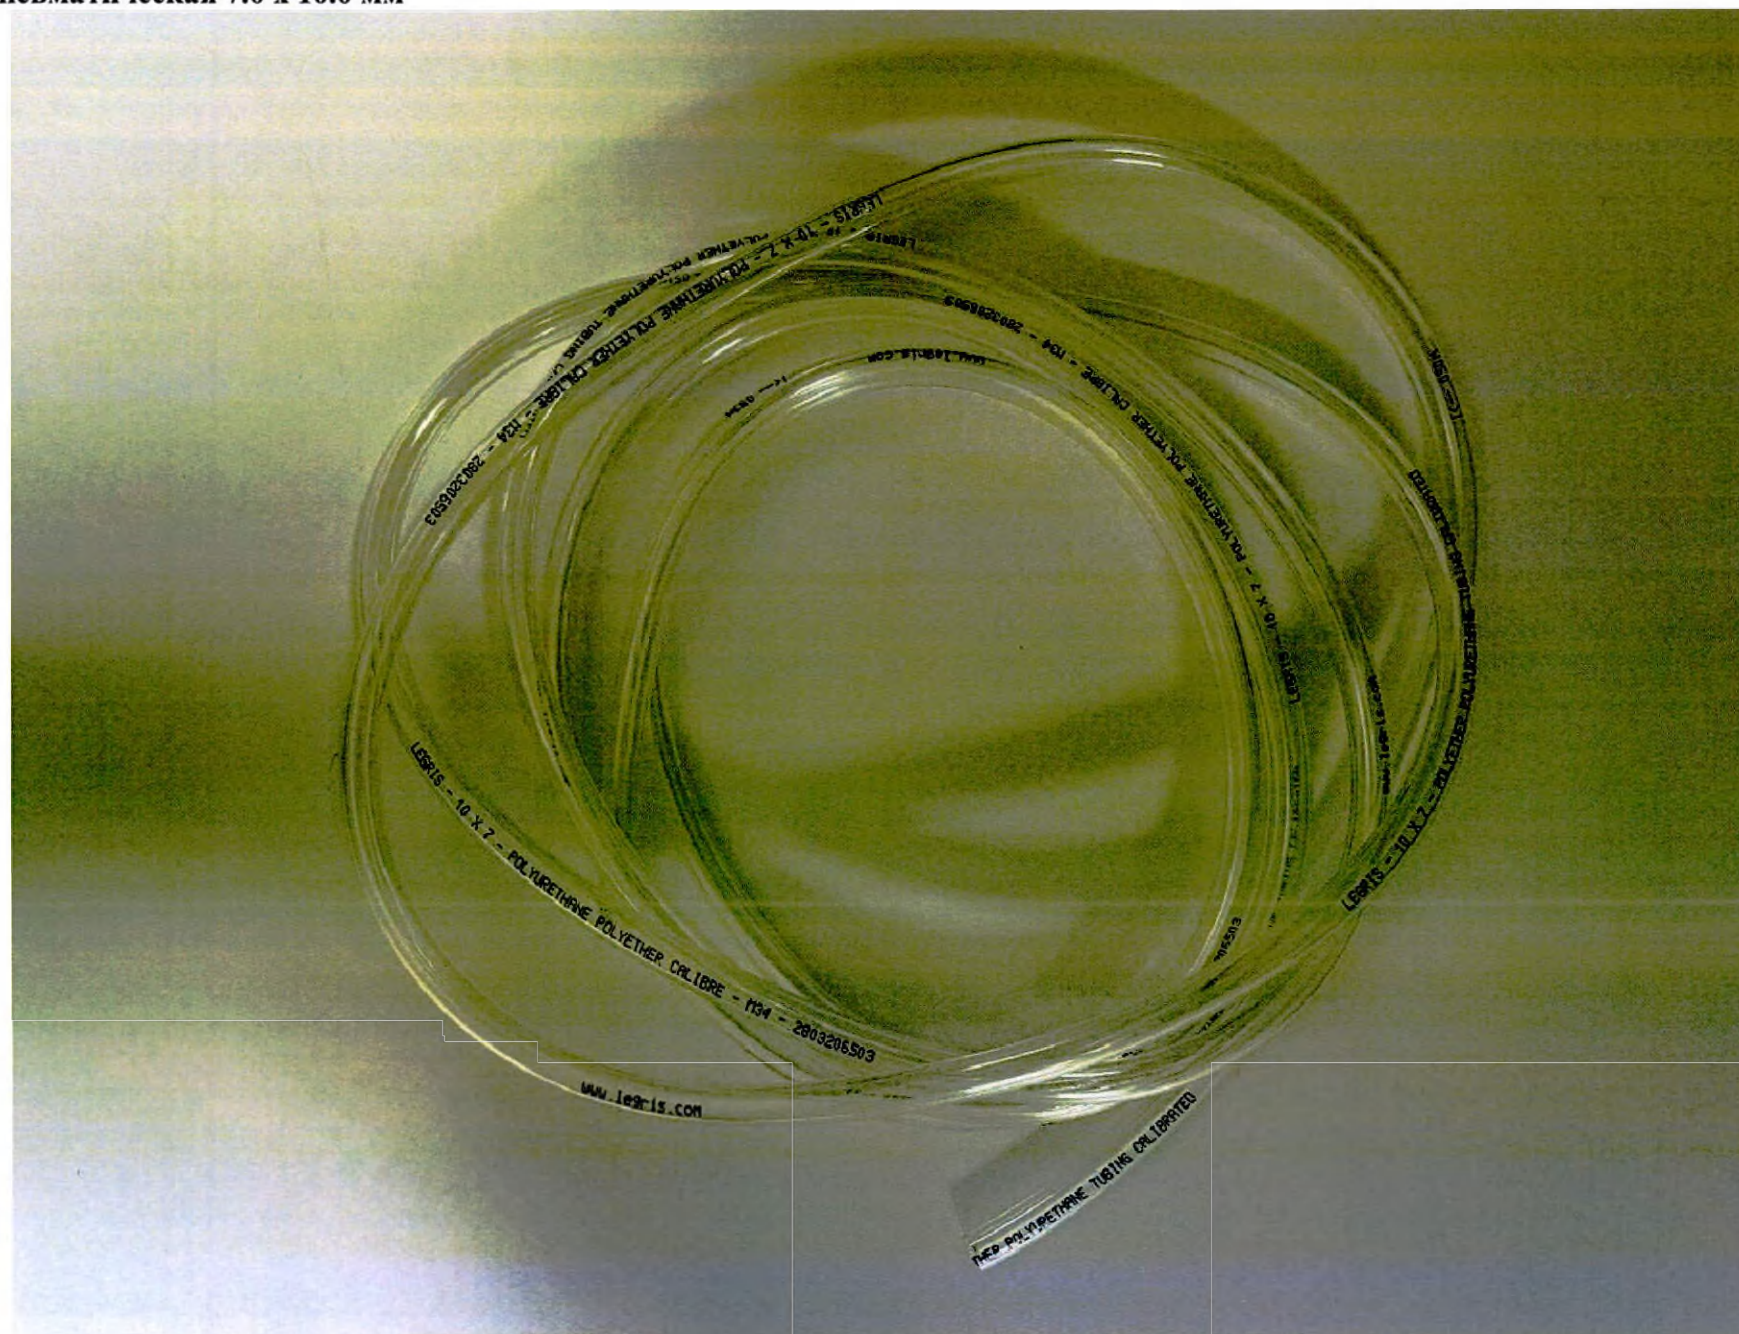


Поддон для реагентов




Крышка модуля ISE защитная

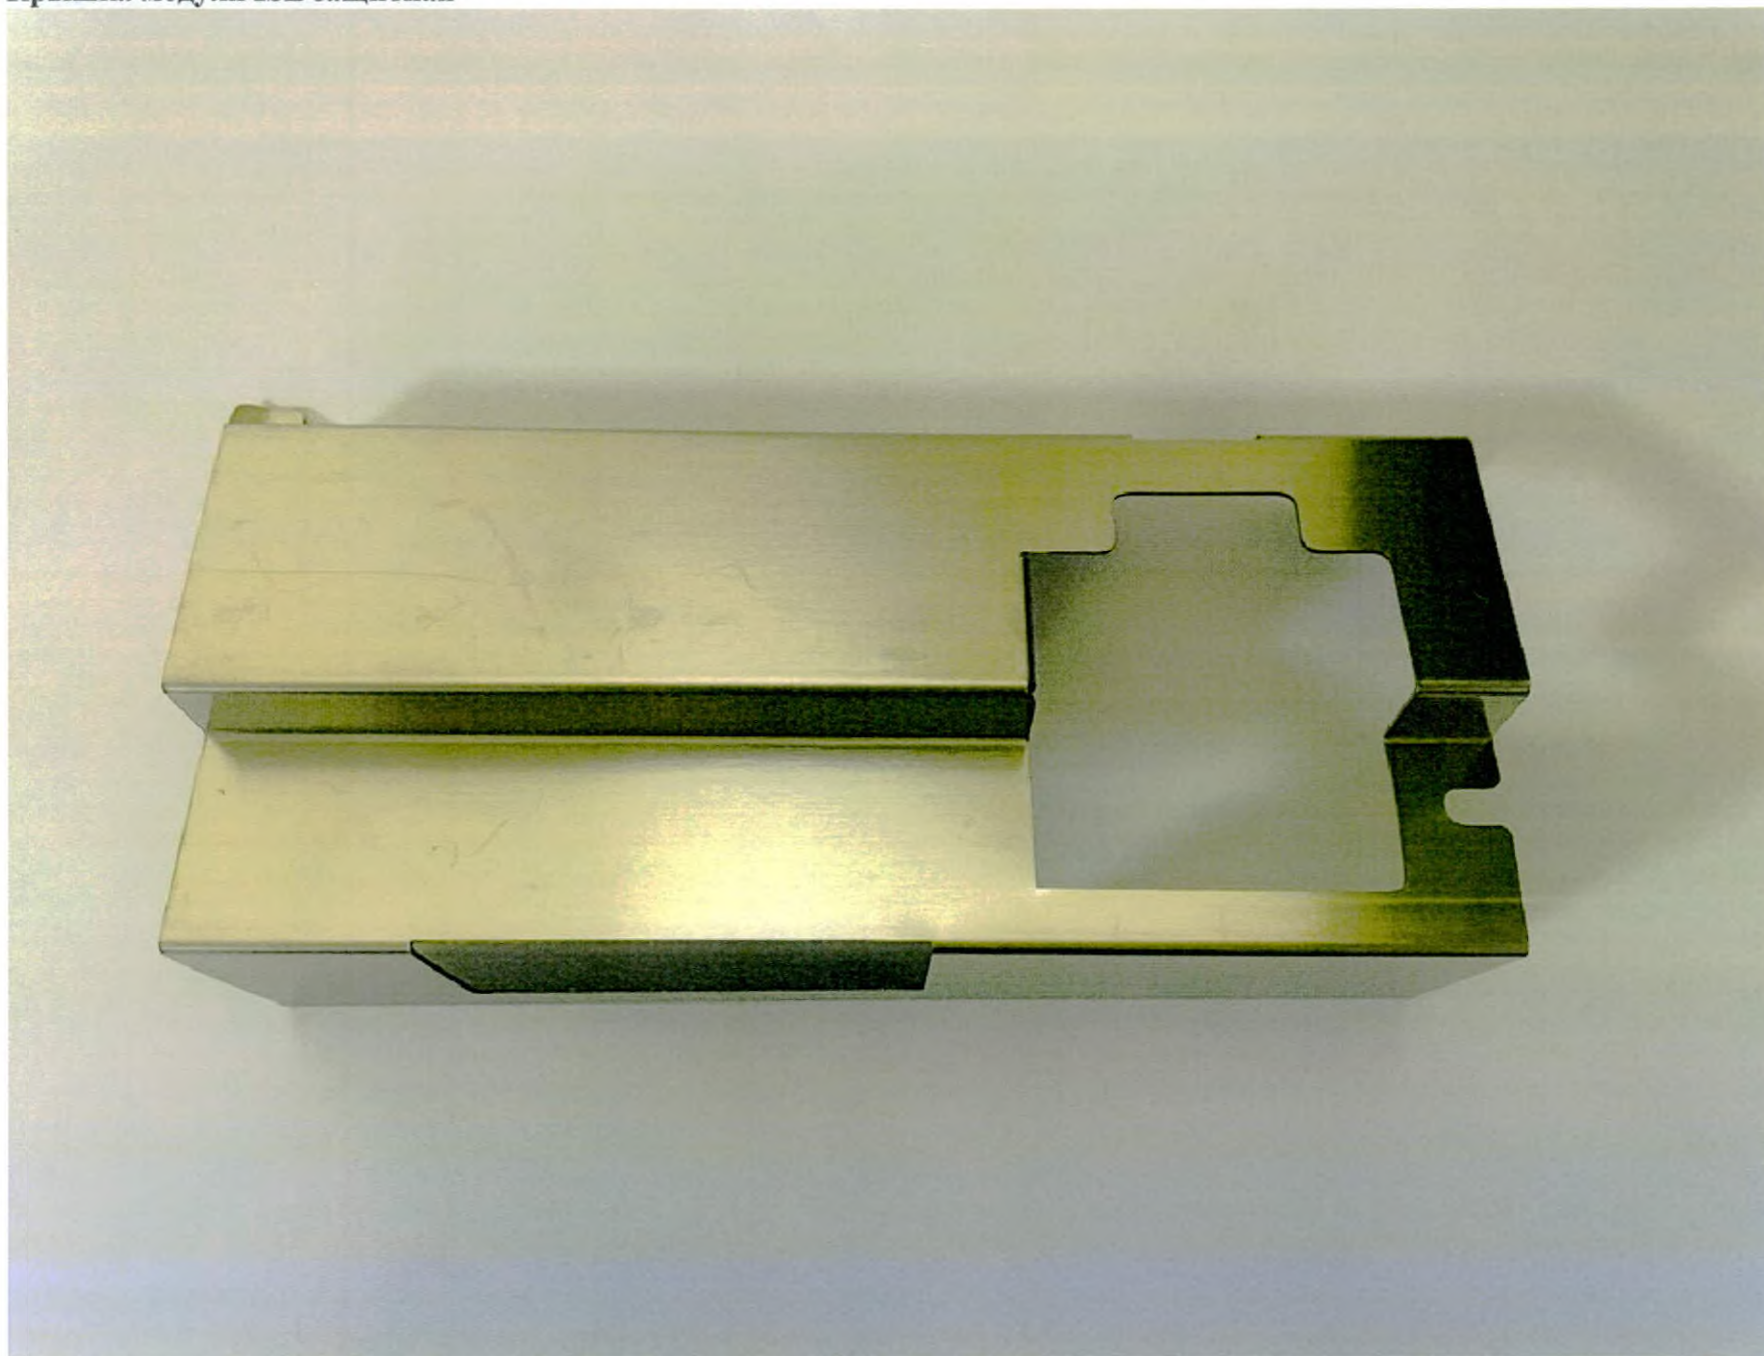


Правая панель внешнего кожуха кронштейна для монитора

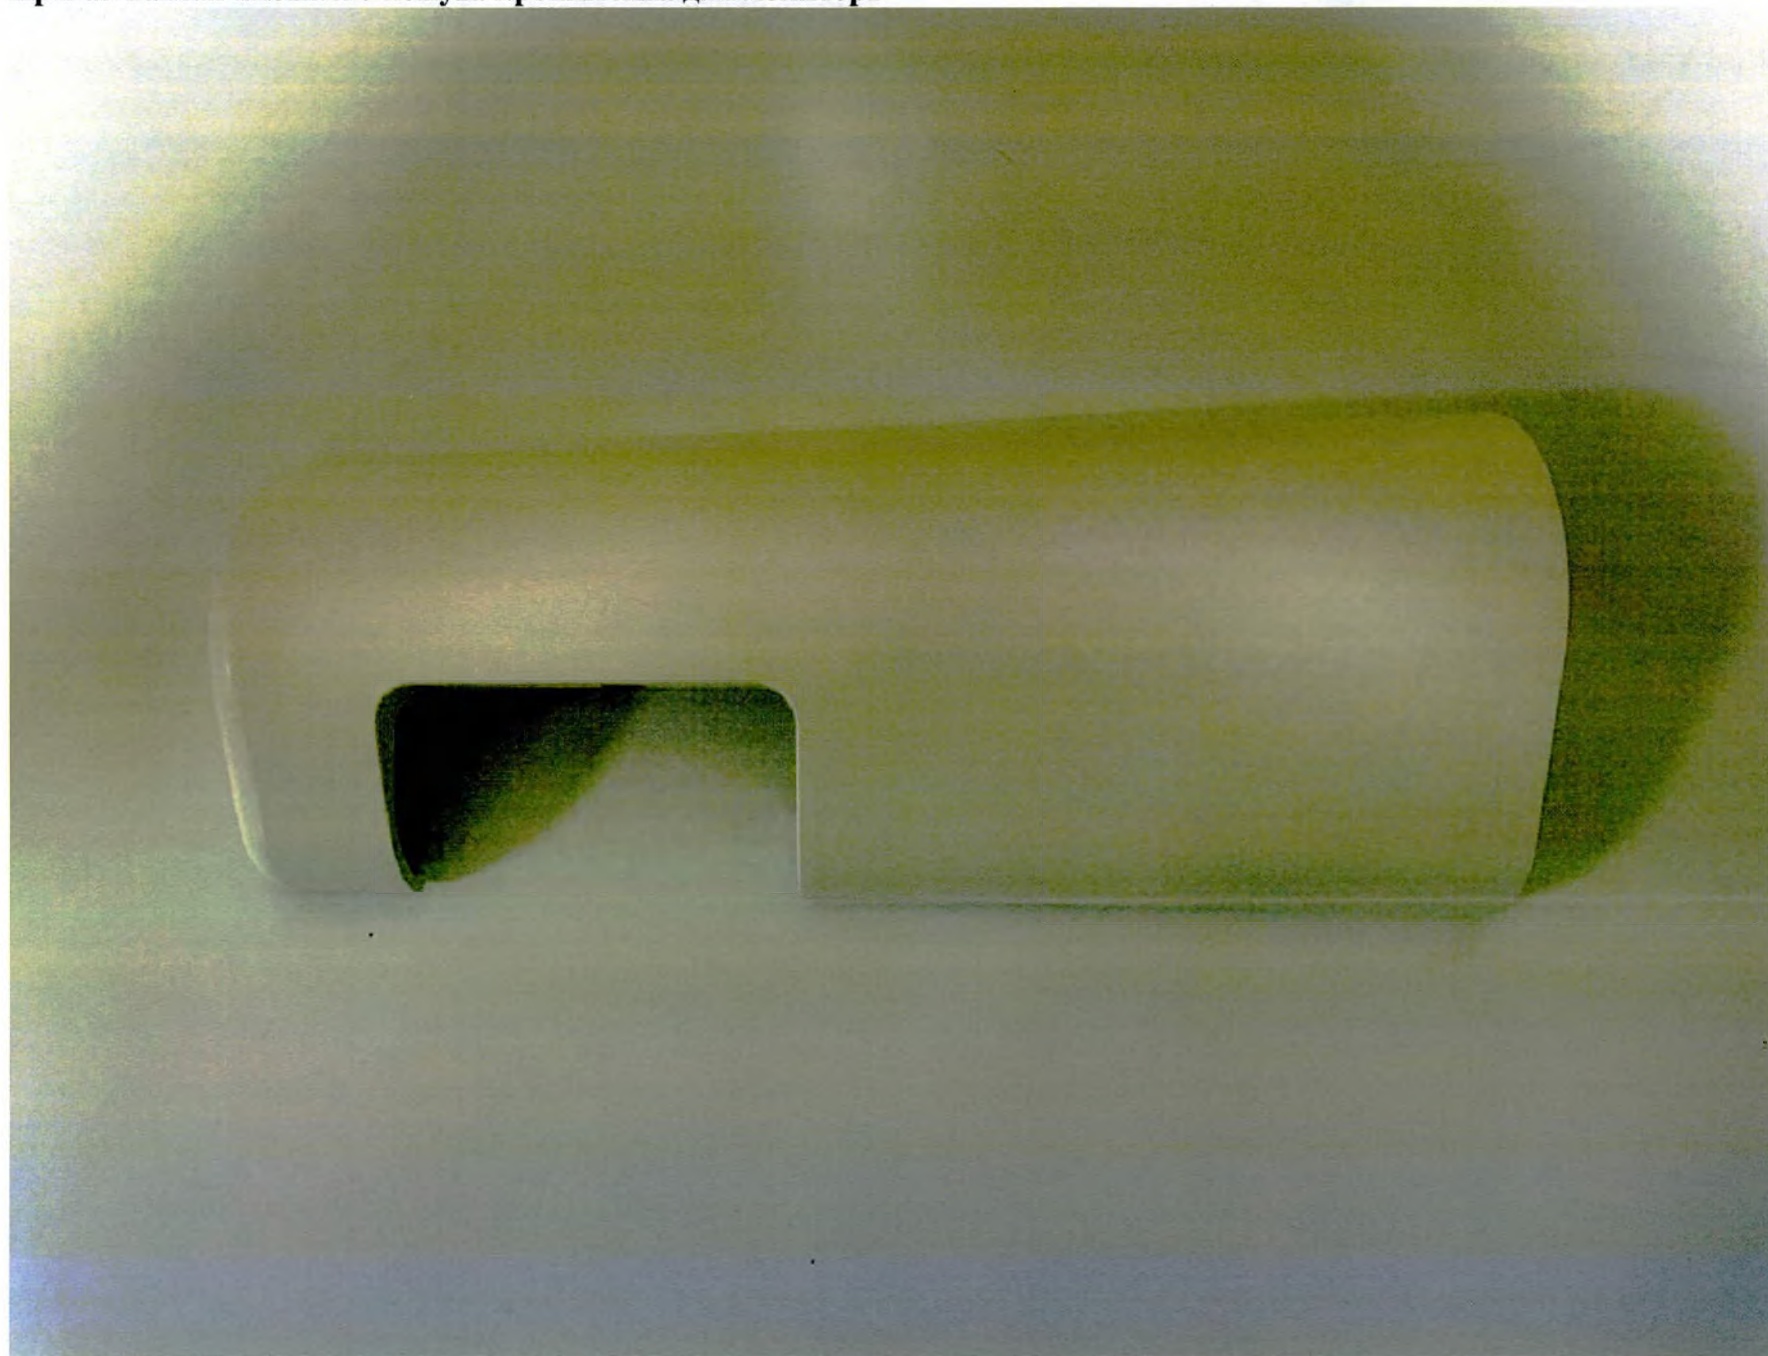


Левая панель внешнего кожуха кронштейна для монитора

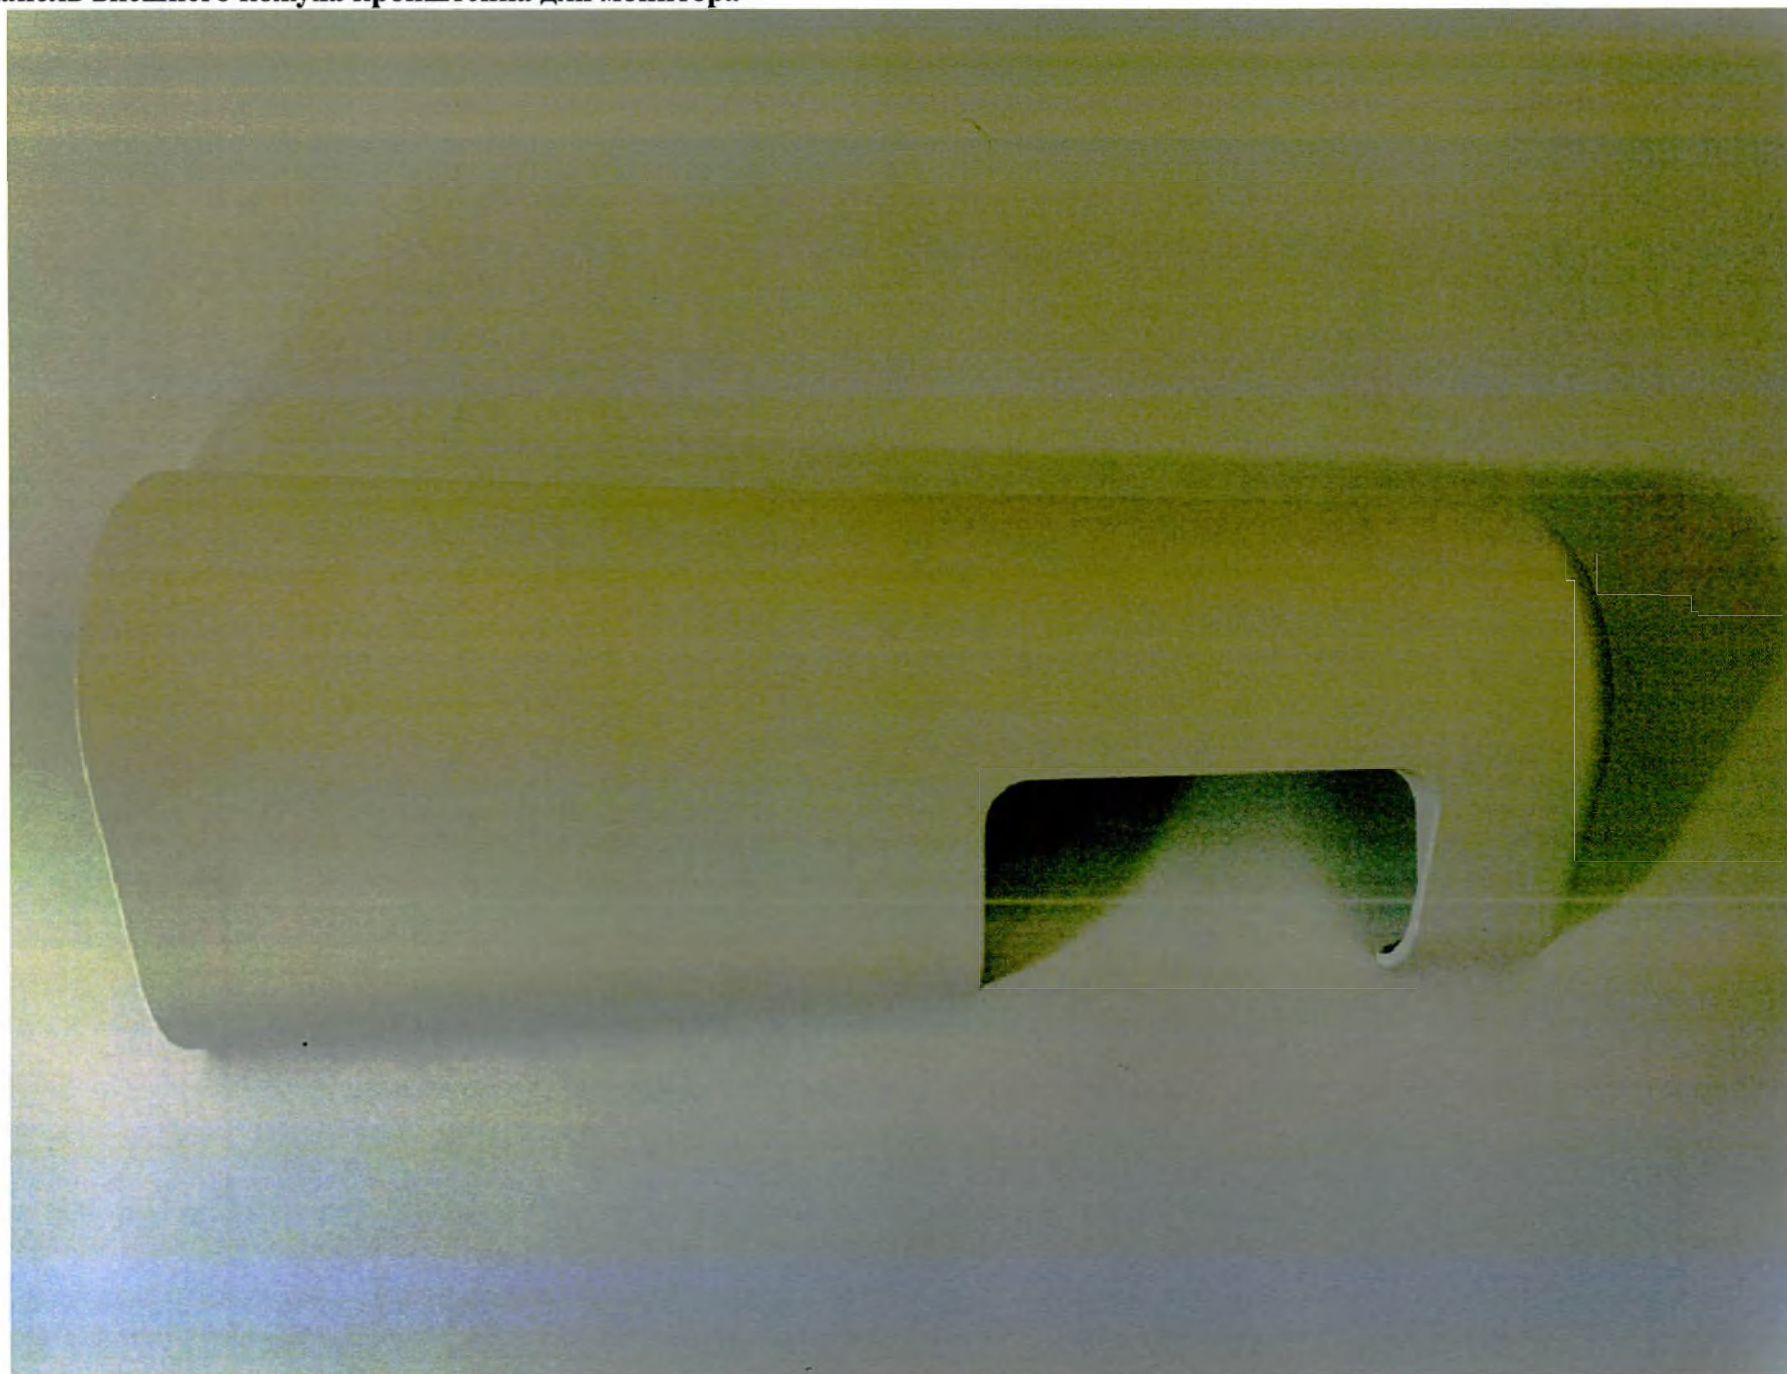


Сменная линия трека перемещения образцов

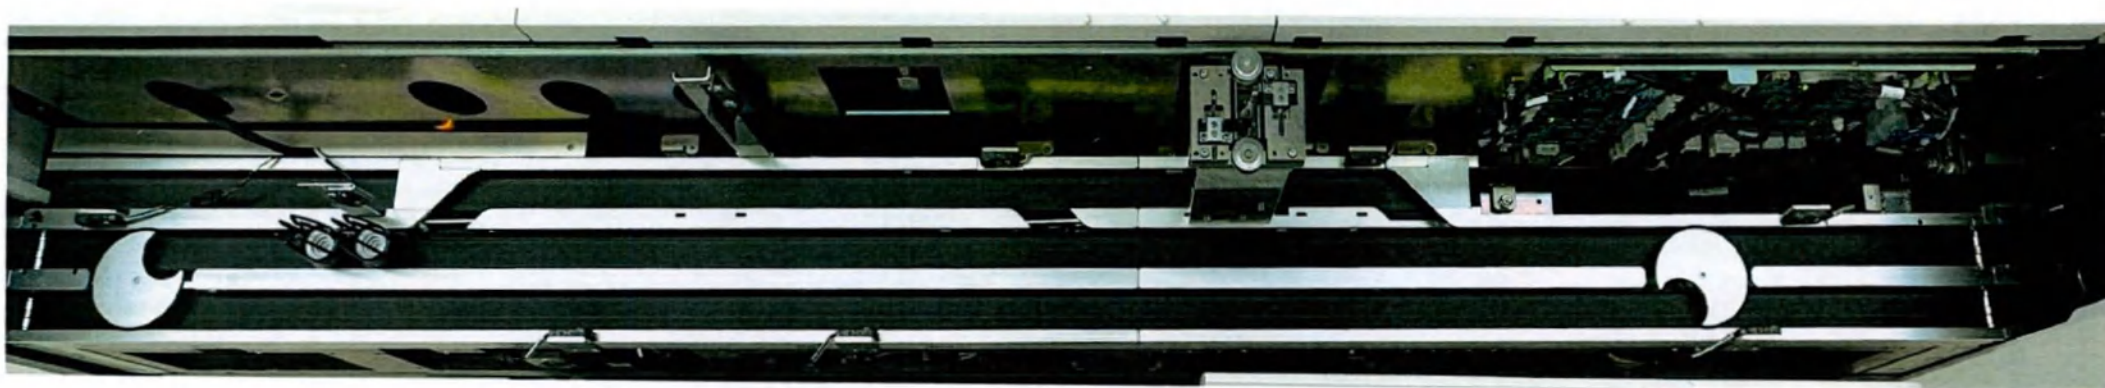


Ременная установка линии трека перемещения образцов

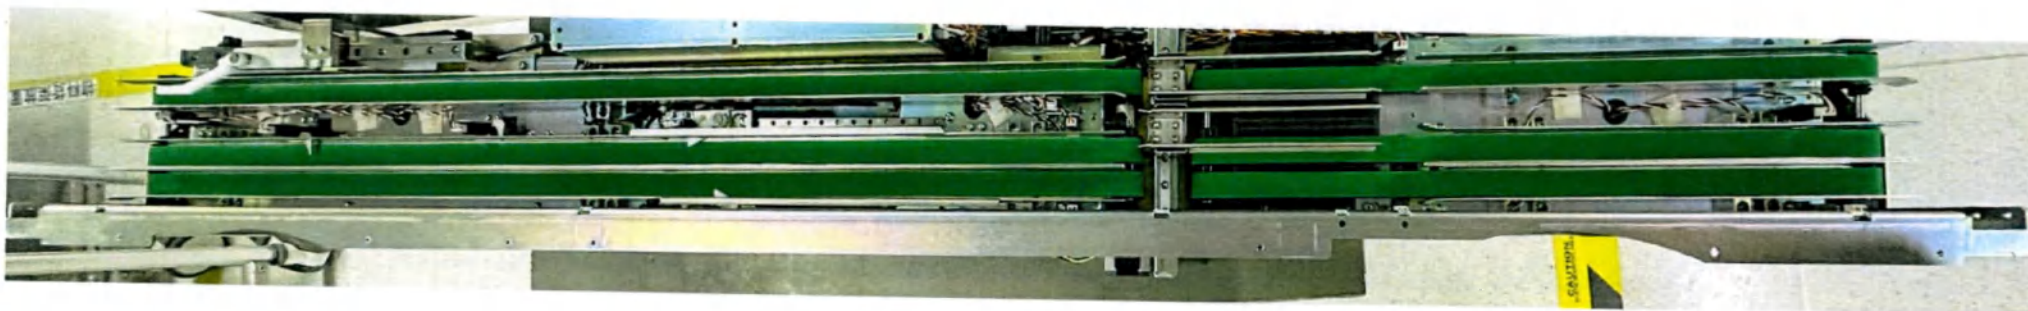


Поворотный механизм трека перемещения образцов

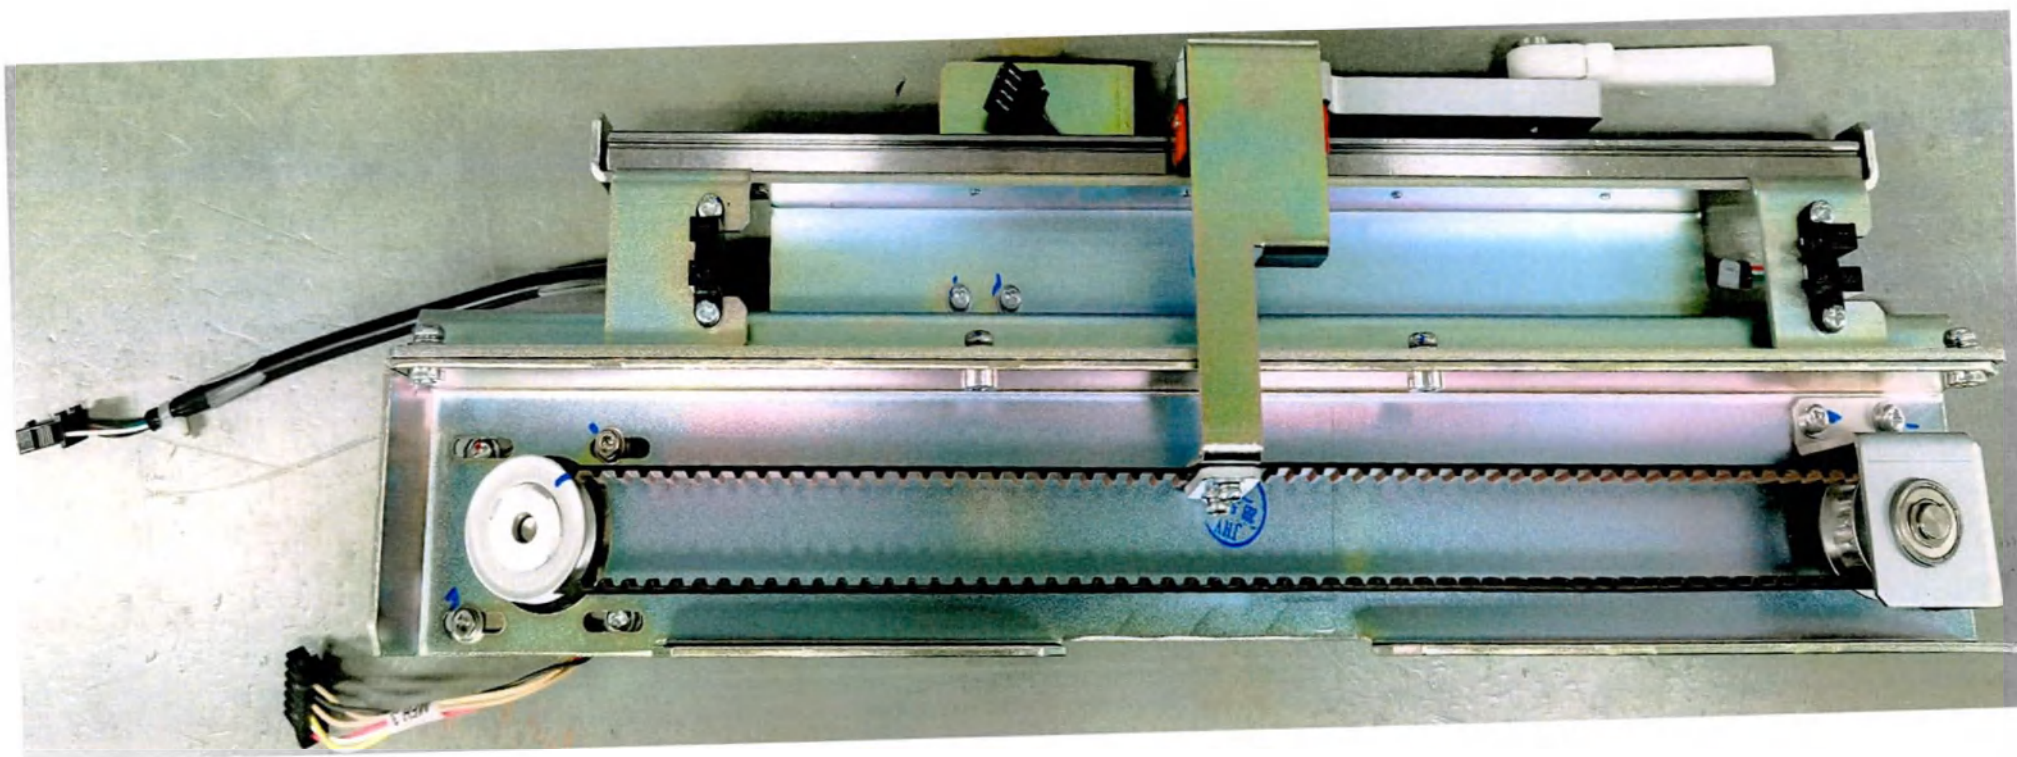


Правая боковая панель защитного кожуха

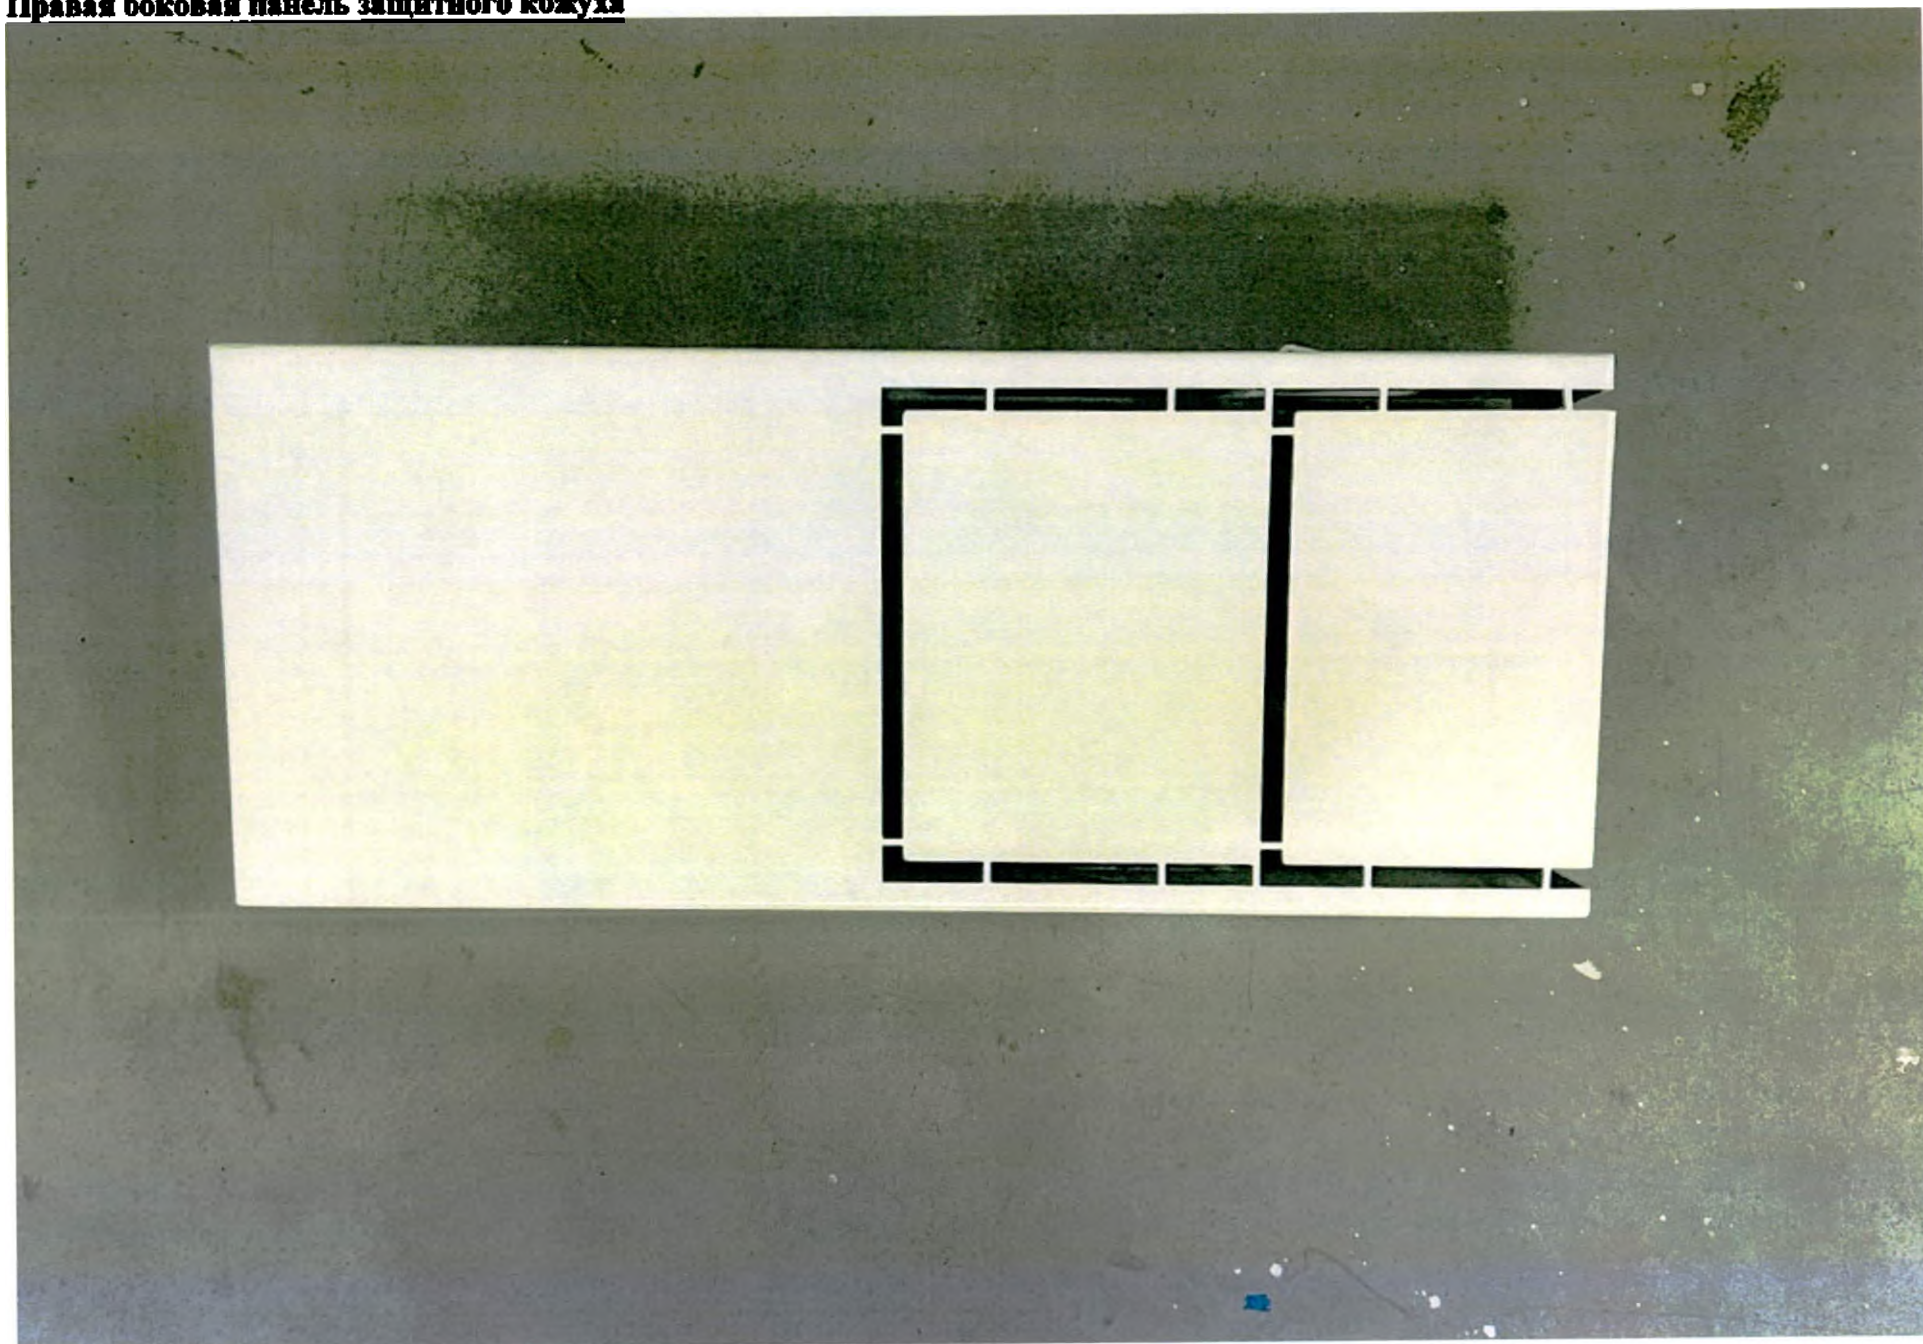


Левая боковая панель защитного кожуха

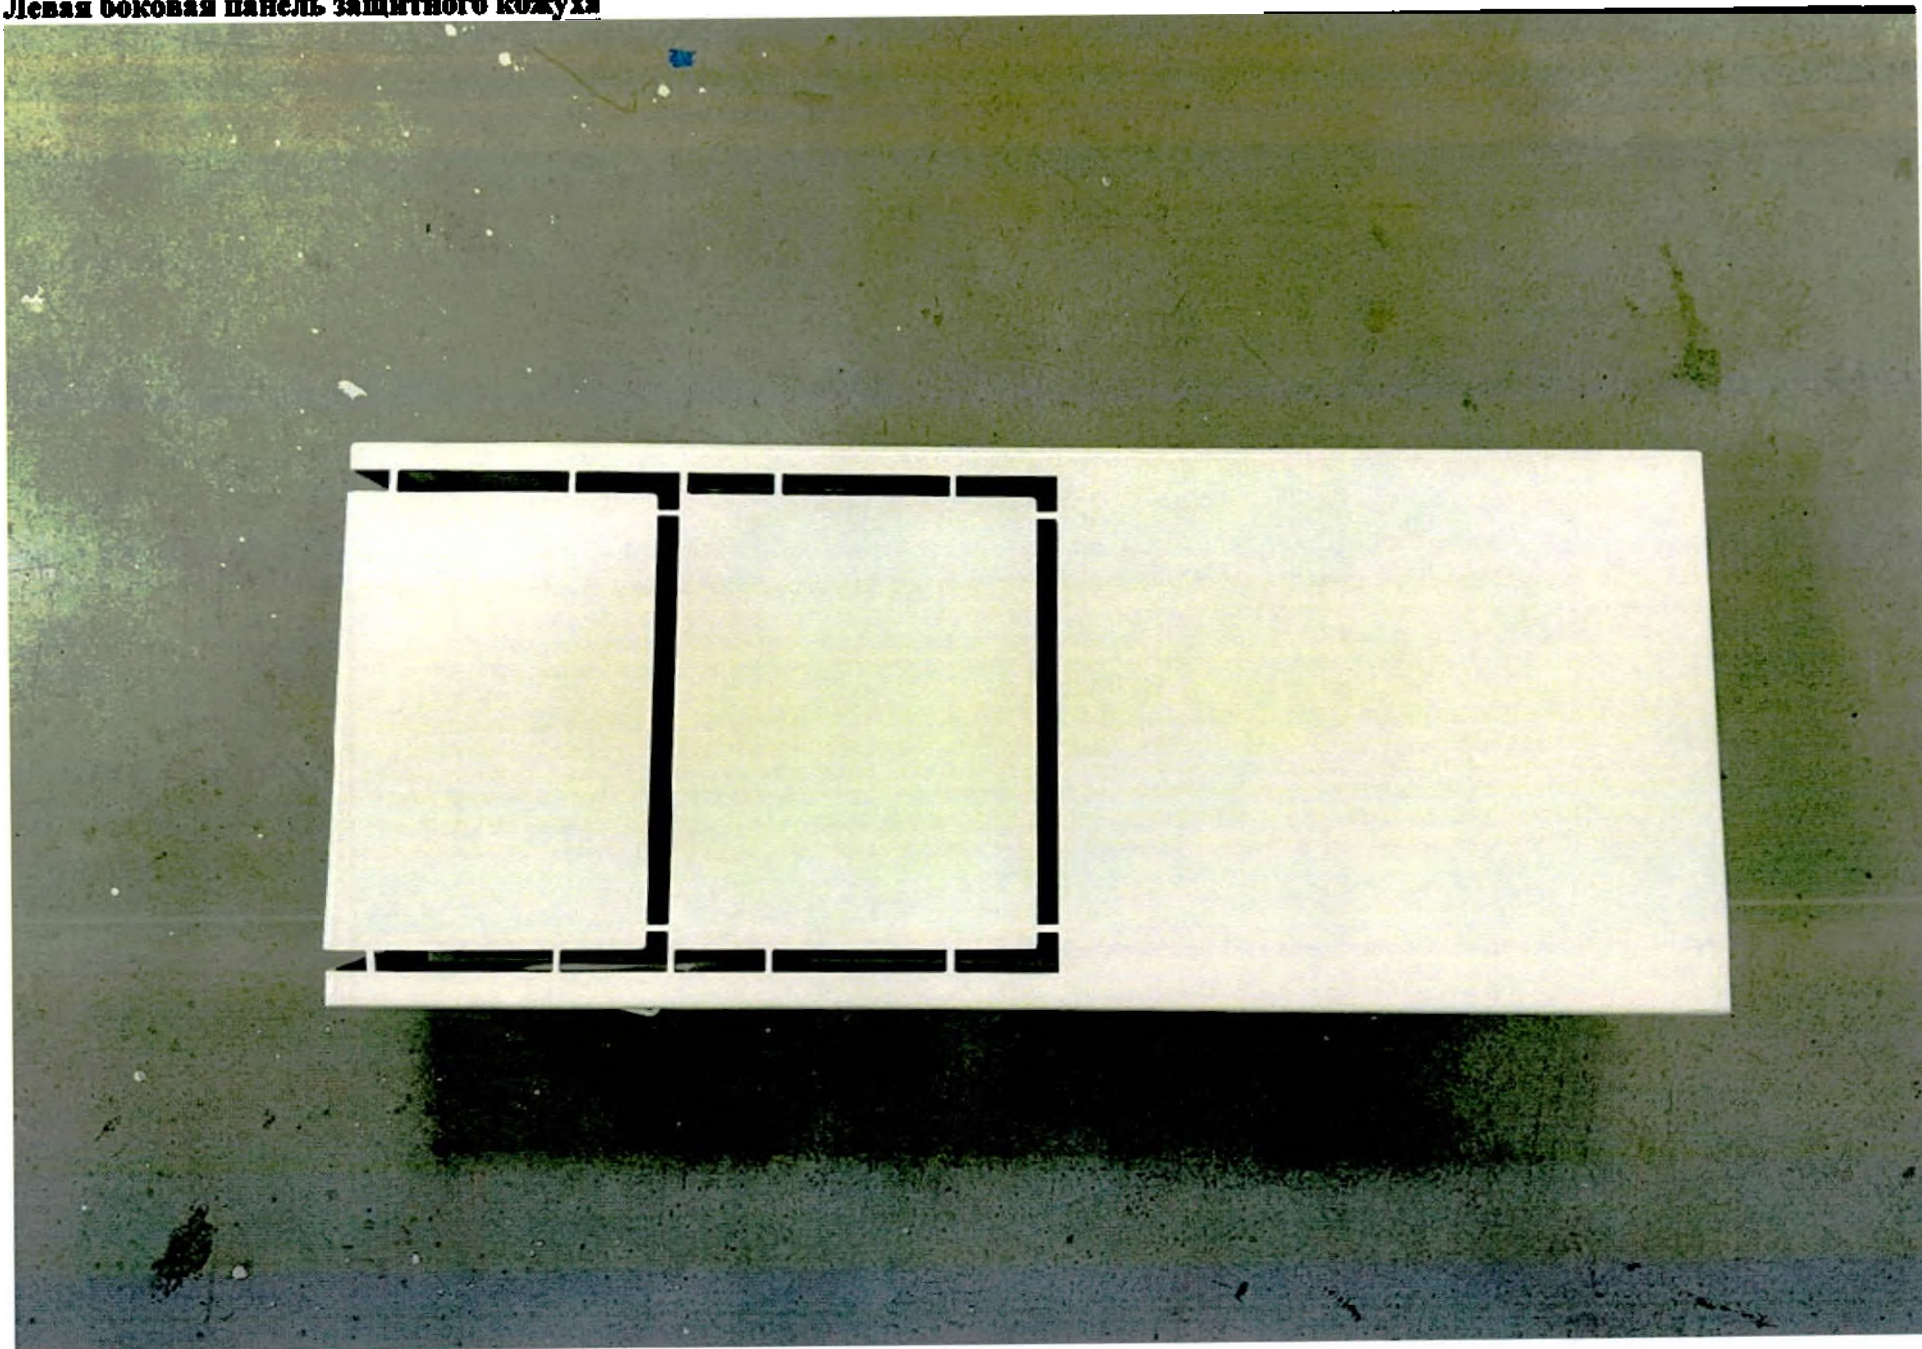

Верхняя панель защитного кожуха основного блока

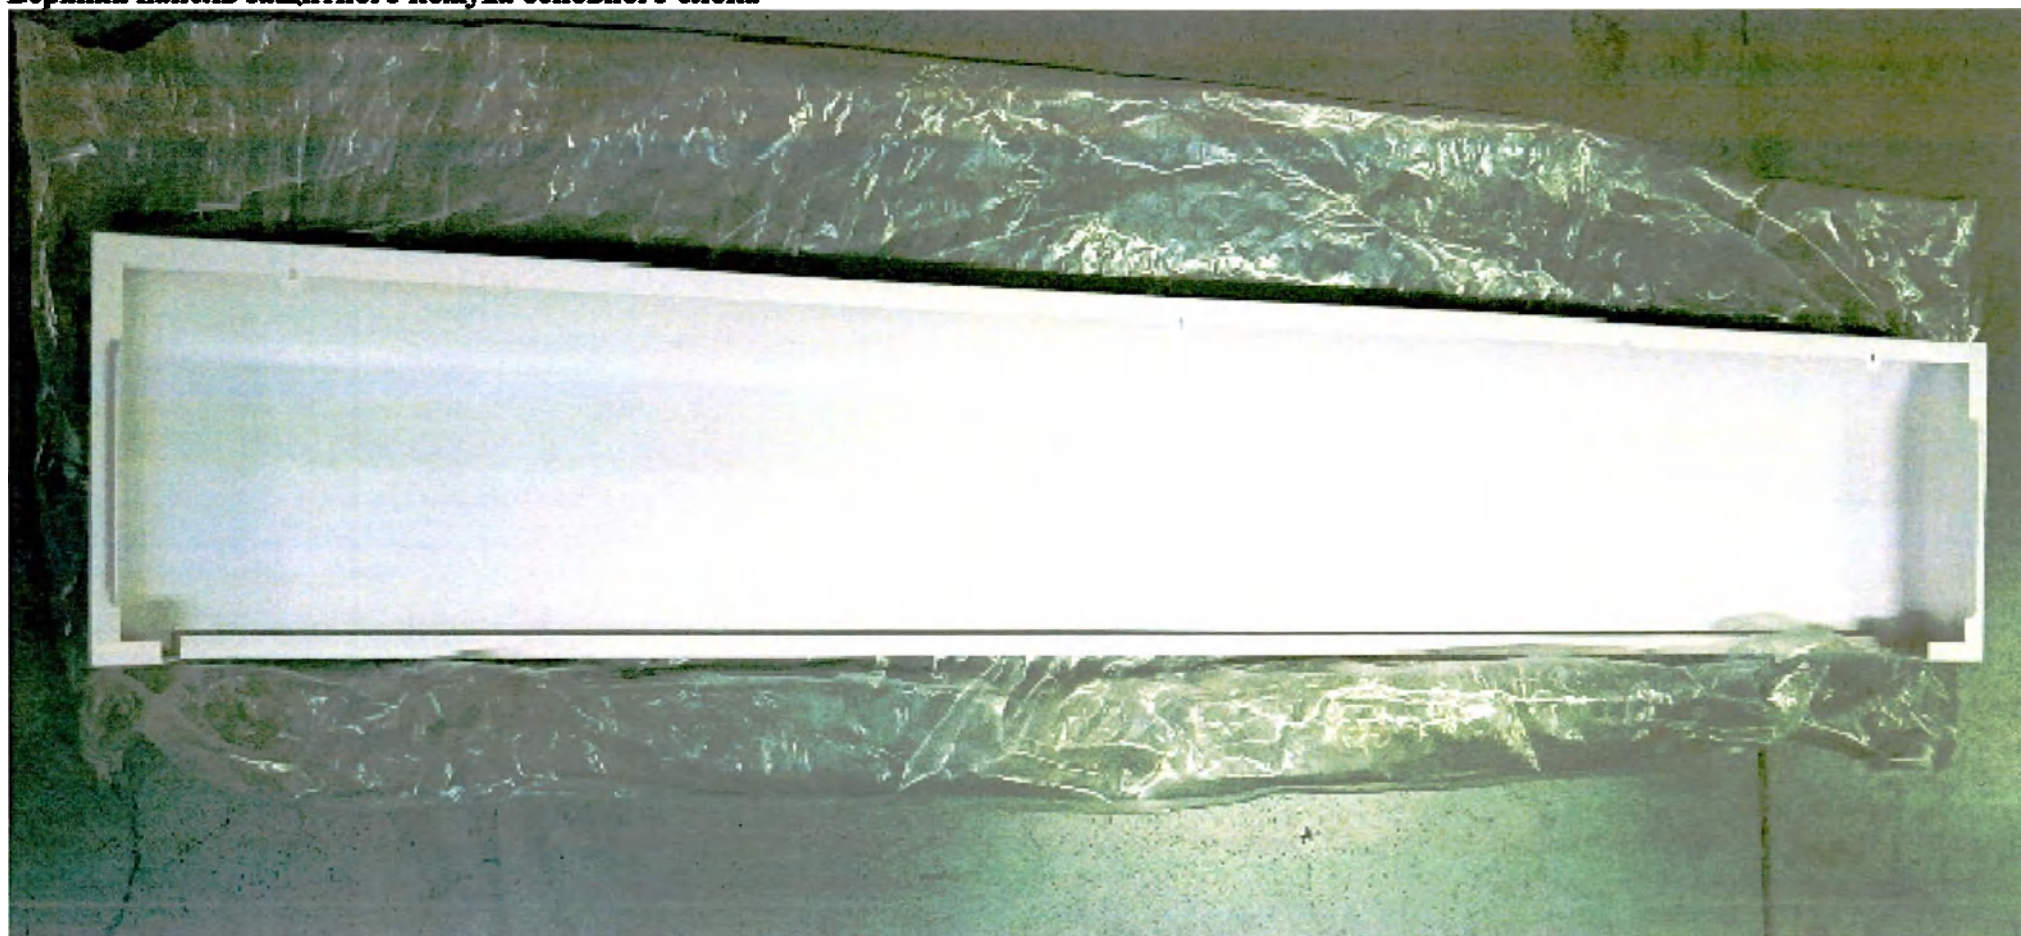


Задняя панель защитного кожуха основного блока

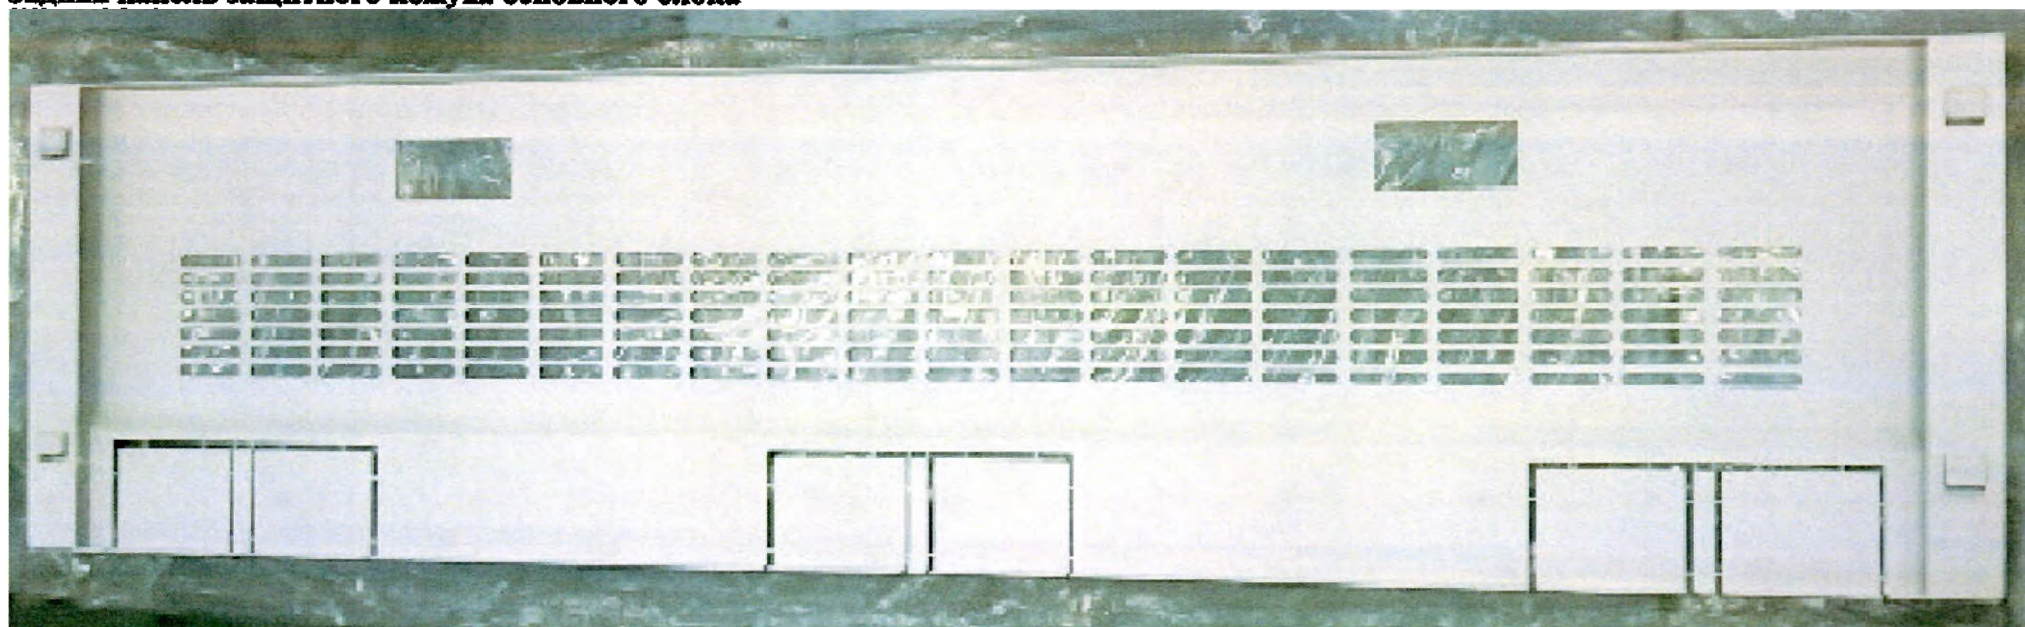

Задняя панель защитного кожуха автозагрузчика




Верхняя панель защитного кожуха автозагрузчика

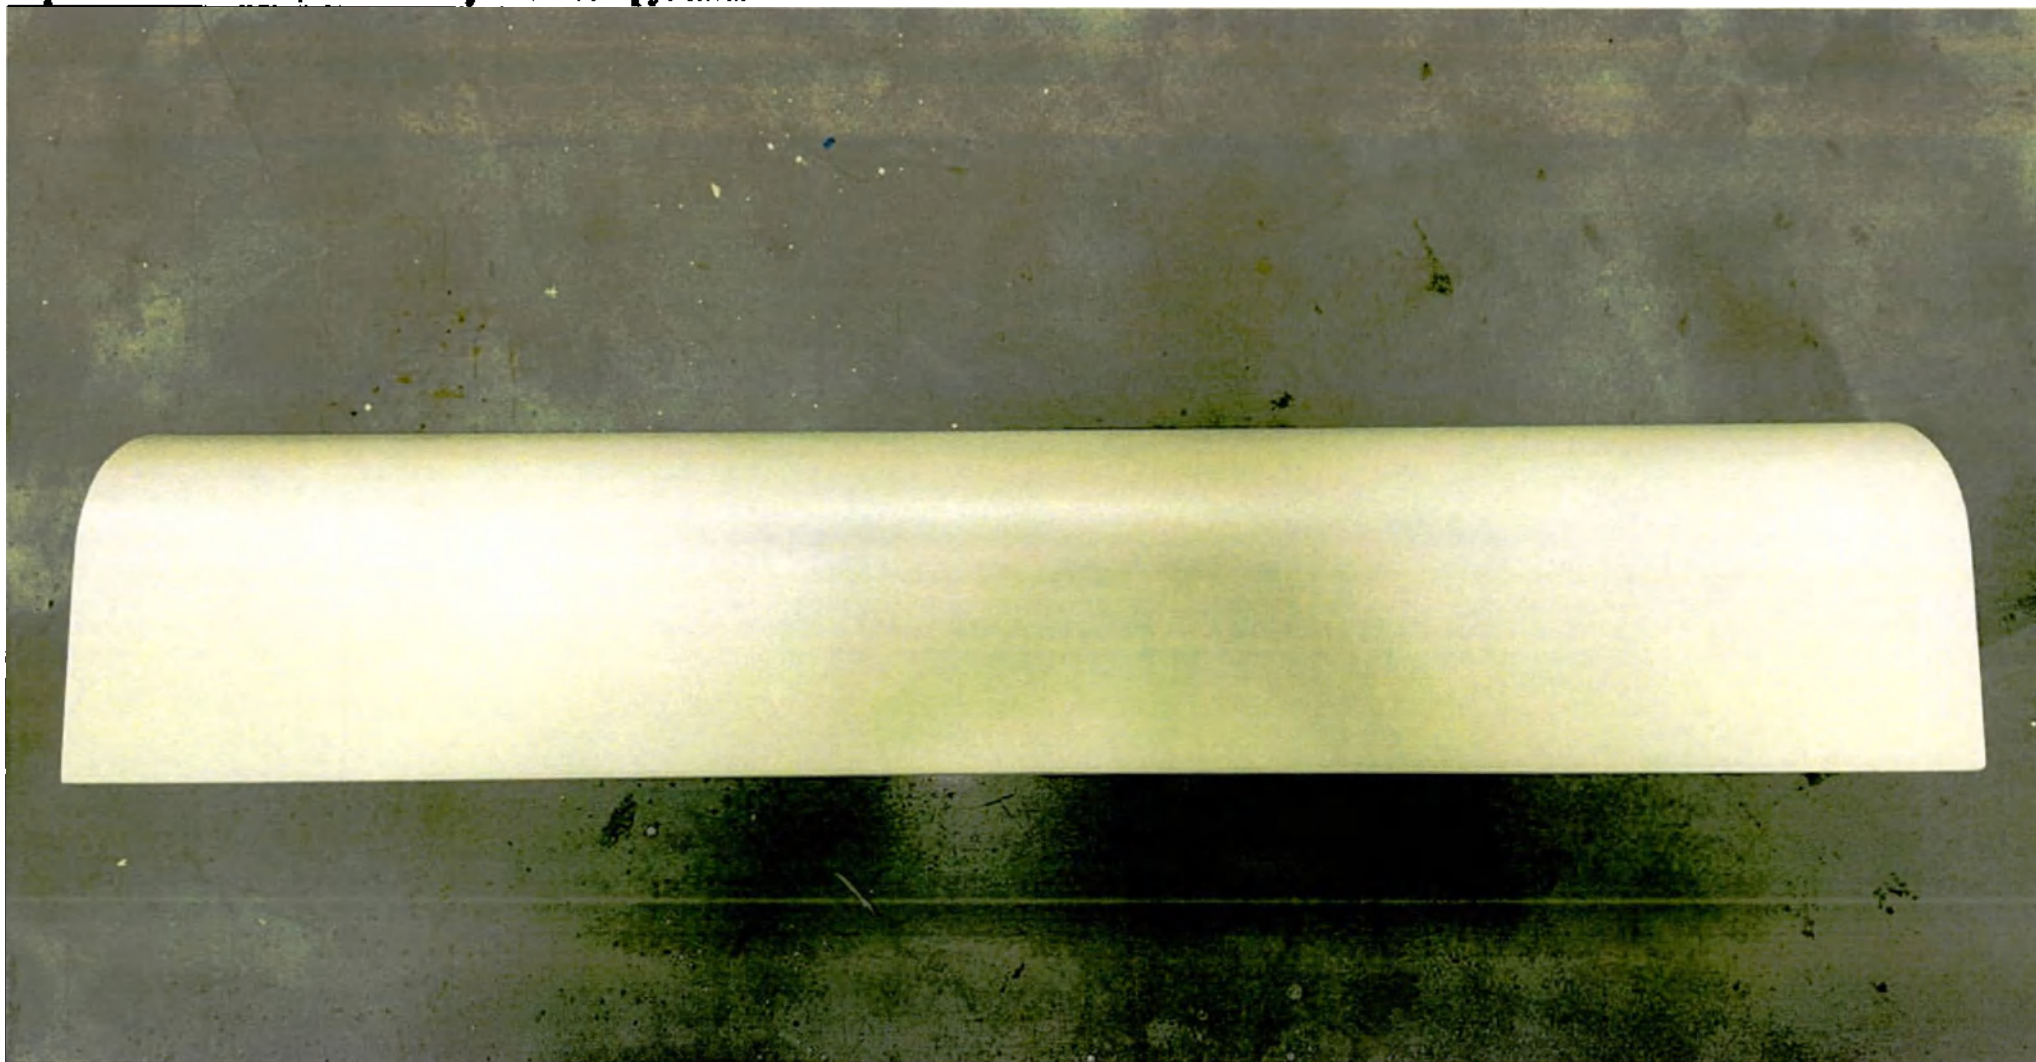

Кронштейн для соединения основных блоков



Кронштейн для соединения основного блока и автозагрузчика

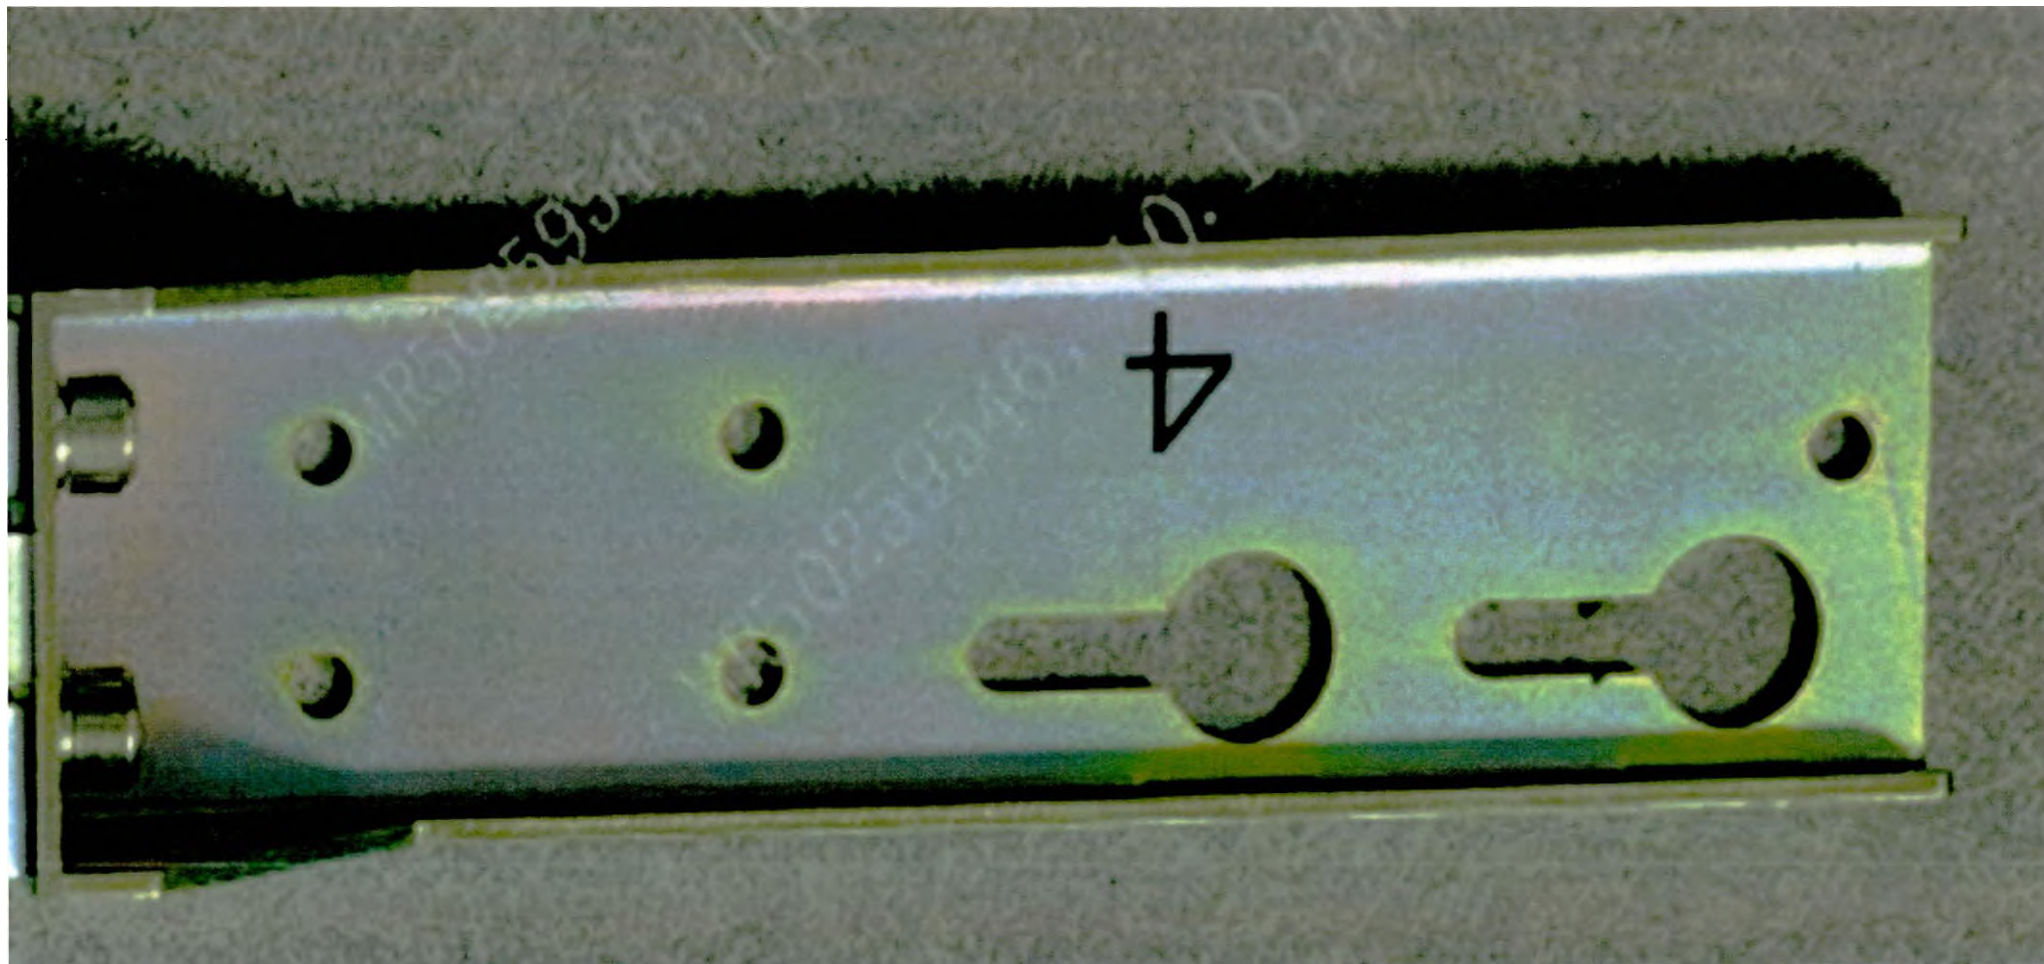

Кронштейн для защитного кожуха автозагрузчика



Кронштейн установочный для правой боковой панели защитного кожуха



Кронштейн для левой боковой панели защитного кожуха





ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ
126 листов



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23Г
СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

