

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

Набор реагентов

**«Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов
класса G к дифтерийному анатоксину "ИФА-Дифтерия-IgG"
по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»**

Макет маркировки

Мишуткина Я.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

«15»

2024

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

АО «ЭКОлаб»

«Тест-система иммуноферментная для определения
иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину

ИФА-Дифтерия-IgG» по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»

Состав набора

Иммуносорбент

Калибровочные пробы (КП1, КП2, КП3, КП4, КП5)

КО, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(х25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Планшет полимерный плоскодонный
для иммуноферментных исследований
однократного применения

Пл-«Б-М» по ТУ 9393-009-16548645-2005:
разборный с фиксатором, РУ № ФСР 2010/08676

Наконечники универсальные
для автоматических дозаторов
по ТУ 32.50.50-001-33793949-2019: Наконечники

универсальные для автоматических
дозаторов объемом (0,5 - 250) мкл, РУ № РЗН 2021/14326

Изделие для запечатывания планшетов
по ТУ 32.50.50-009-48072026-2022: Пленка клейкая

для планшетов с одной насечкой, РУ № РЗН 2022/19122

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые емкости

Бланк калибровочного графика

1 планшет

5 фл. (по 1,5 мл)

1 фл. (1,5 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

1 шт.

16 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

АО «ЭКОлаб»

ИФА-Дифтерия-IgG

ТУ 21.20.23-367-70423725-2023

РУ

LOT

02

2023.10.17

REF
















42.33

2025.04.17

Контрольный № 325



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на коробке

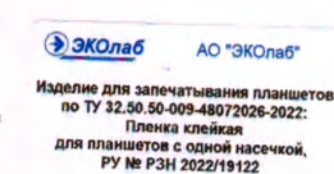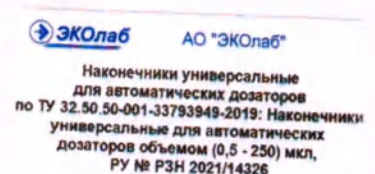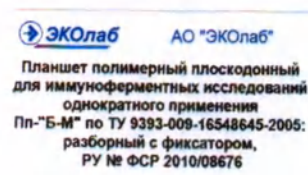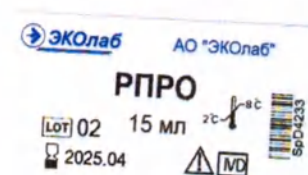

Директор производства ДП:

Handwritten signature

Мишуткина Я.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

2024



Макет маркировки транспортной упаковки

Для профессионального применения

АО "ЭКОлаб"

Набор реагентов

«Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину

"ИФА-Дифтерия-IgG" по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»

ТУ 21.20.23-367-70423725-2023

РУ №

LOT 01

REF 42.33

2023.10.16

2025.04.16

Контрольный номер: 324

Количество _____ шт



Юридический адрес: 142530, Московская область,

г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1

Место производства: 142530, Московская область,

г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1а

Тел. 8(800)333-33-47; <https://ekolab.ru/>

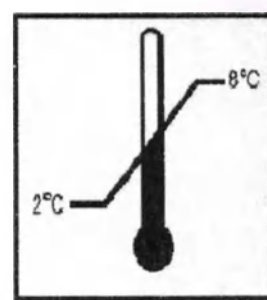

АО "ЭКОлаб"



Handwritten signature

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 2

Ген. директор АО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"06.06" 2024 г.



АО «ЭКОлаб» 142530 Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г.Электрoгорск, ул. Буденного, д.1

e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru

Тел: 8-800-333-33-47

ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ЭКОлаб»


Г.Ю. Гашенко

"20"10.2023 г.


Фотографические изображения

Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG" по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»

Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG" по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»
Код партии (серии): 01, дата изготовления 2023.10.16, годен до 2025.04.16

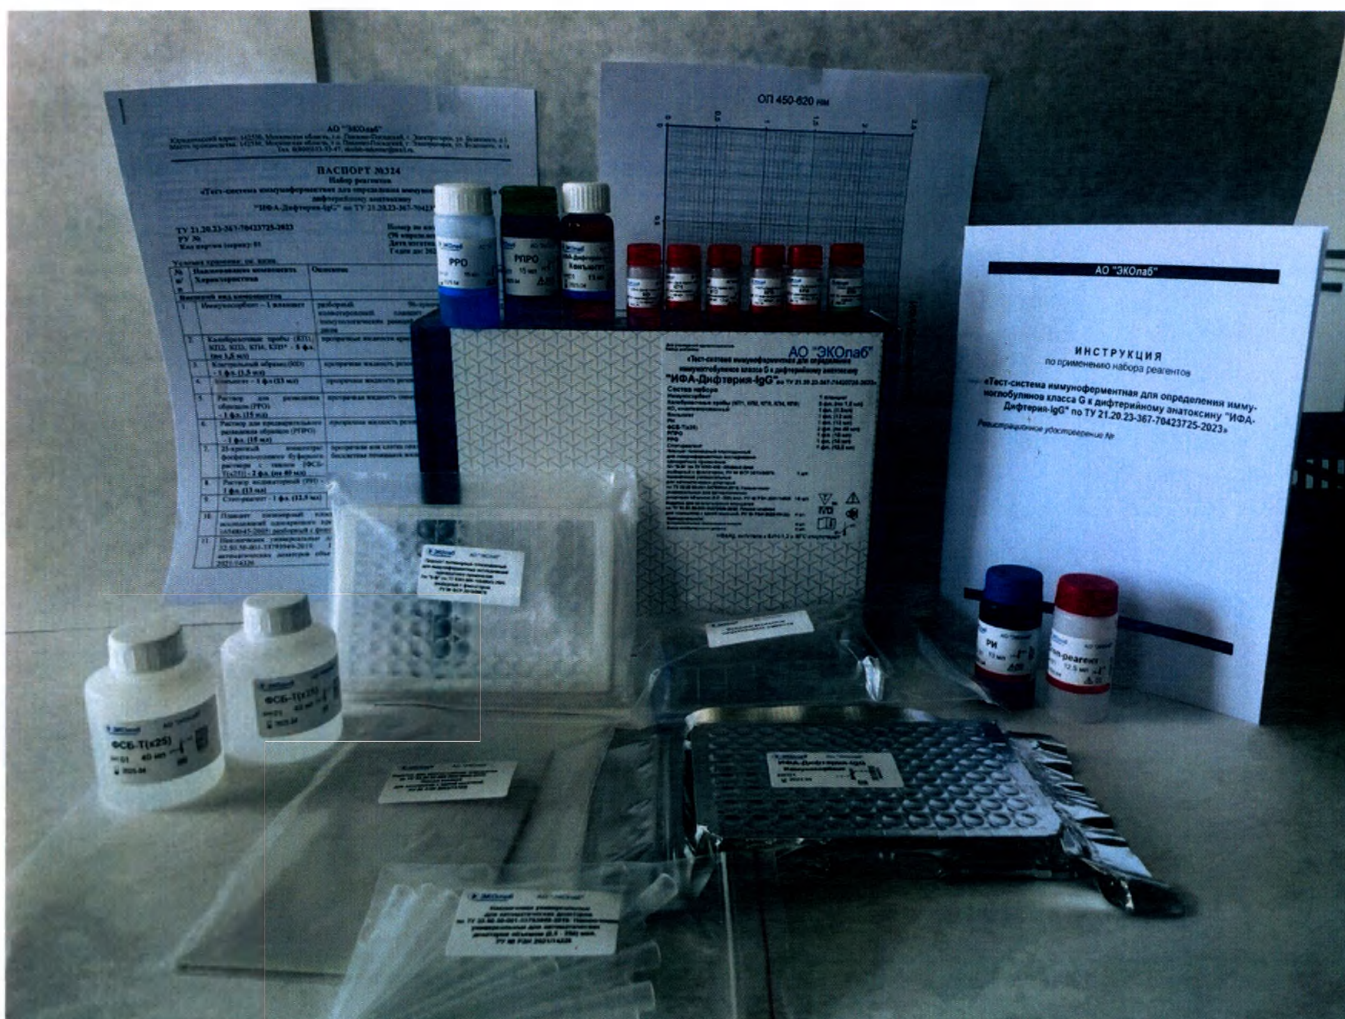

Код партии (серии): 02, дата изготовления 2023.10.17, годен до 2025.04.17

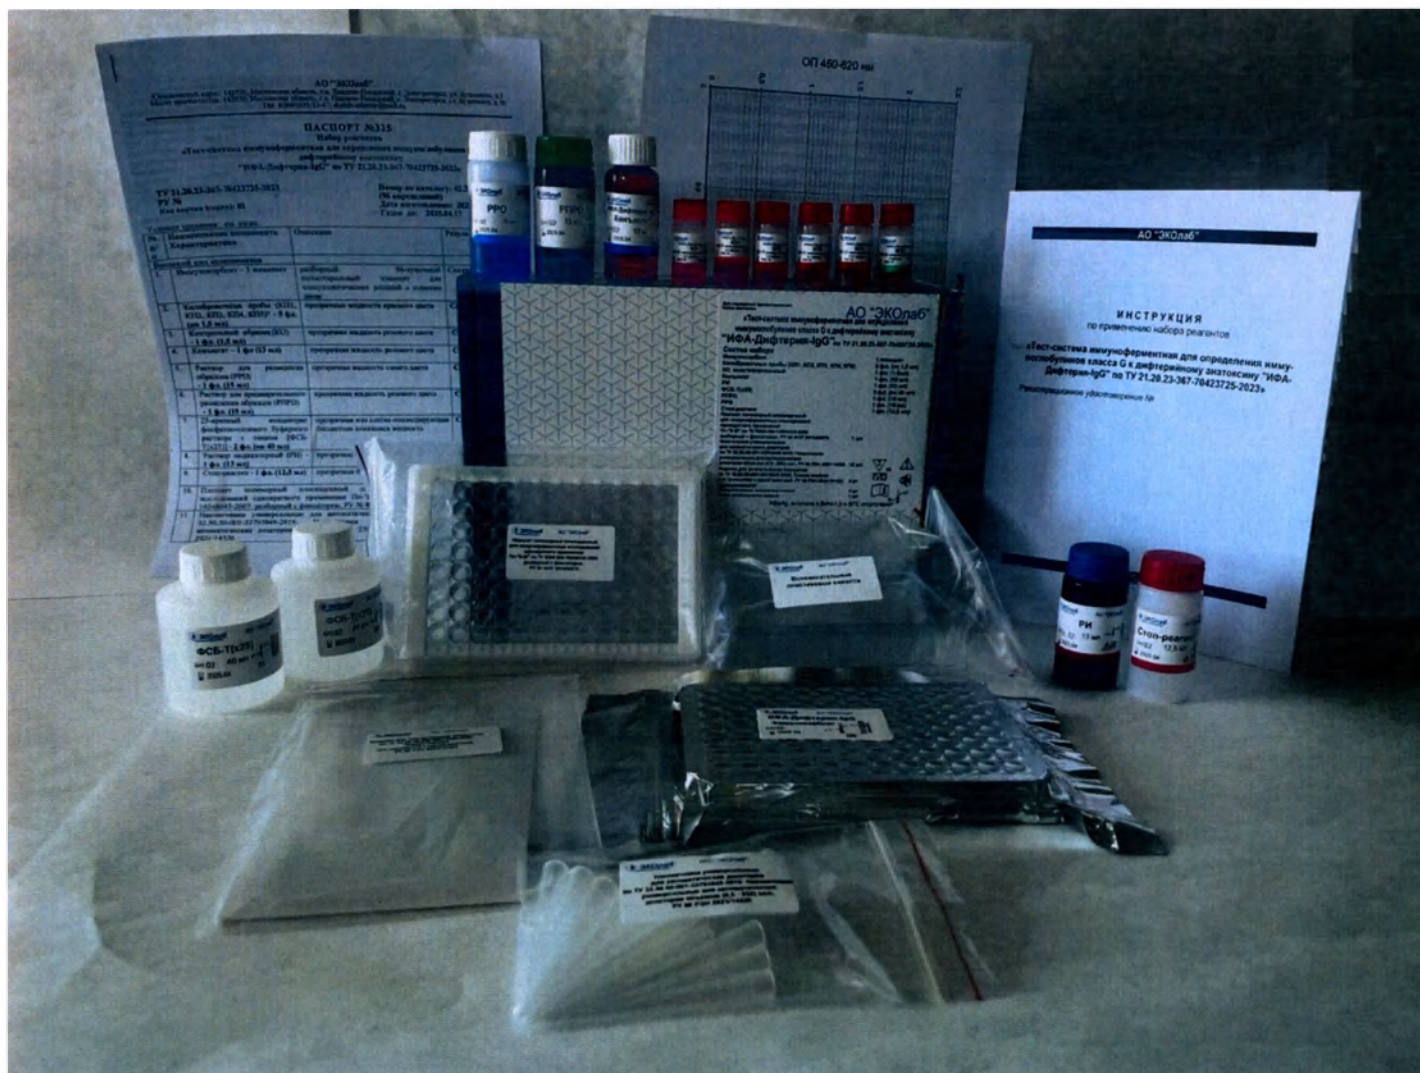

**Фотографическое изображение коробки (не в сборе) набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов
класса G к дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG"
по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»**

Код партии (серии): 01, дата изготовления 2023.10.16, годен до 2025.04.16



Фото компонентов набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов
класса G к дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG"
по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»

Код партии (серии): 01, дата изготовления 2023.10.16, годен до 2025.04.16



Иммуносорбент




Контрольный образец (КО)




Конъюгат




Калибровочные пробы (КП1, КП2, КП3, КП4, КП5)

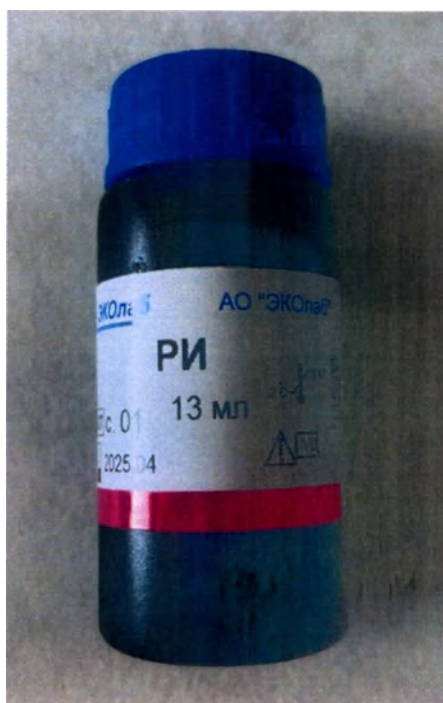


**Раствор
индикаторный (РИ)**

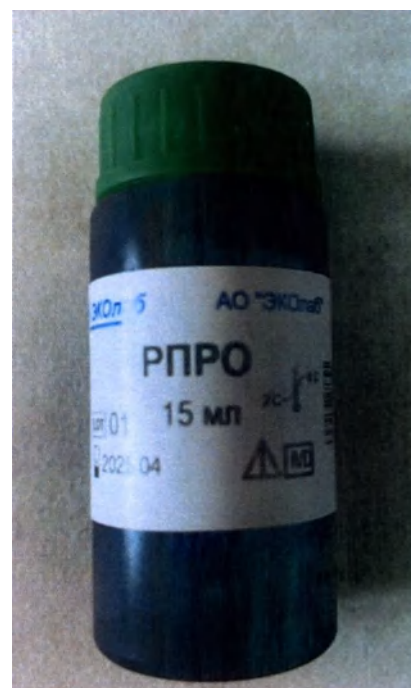


**Раствор для предварительного
разведения образцов (РПРО)**

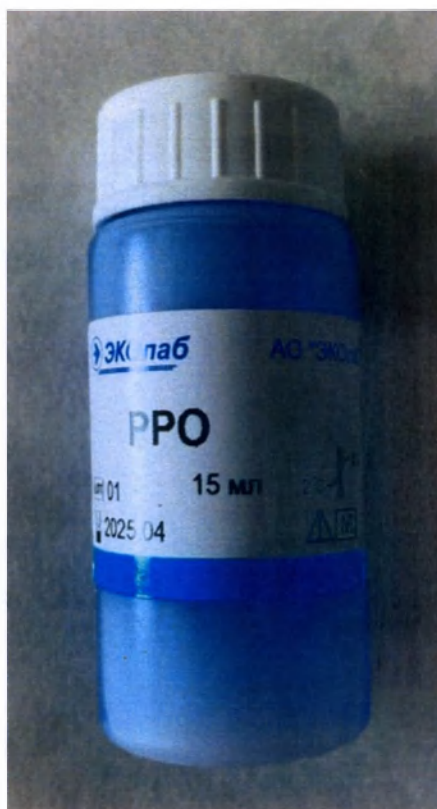

Раствор для разведения
образцов (РРО)

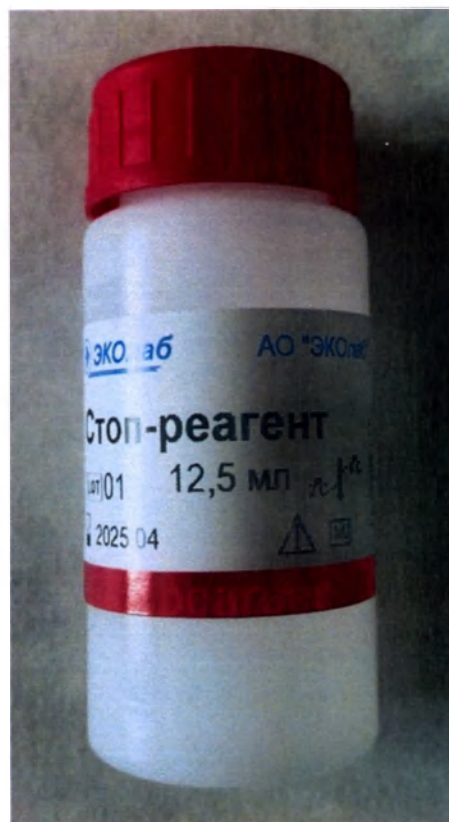

Стоп-реагент

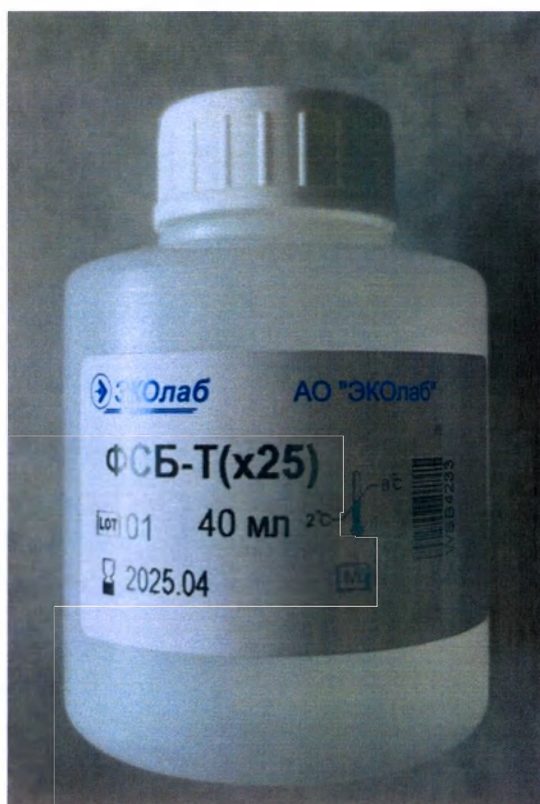

25-кратный концентрат фосфатно-солевого
буферного раствора с твином [ФСБ-Т(x25)]



Фото планшета полимерного плоскостного для иммуноферментных исследований однократного применения Пп-"Б-М" по ТУ 9393-009-16548645-2005: разборный с фиксатором.

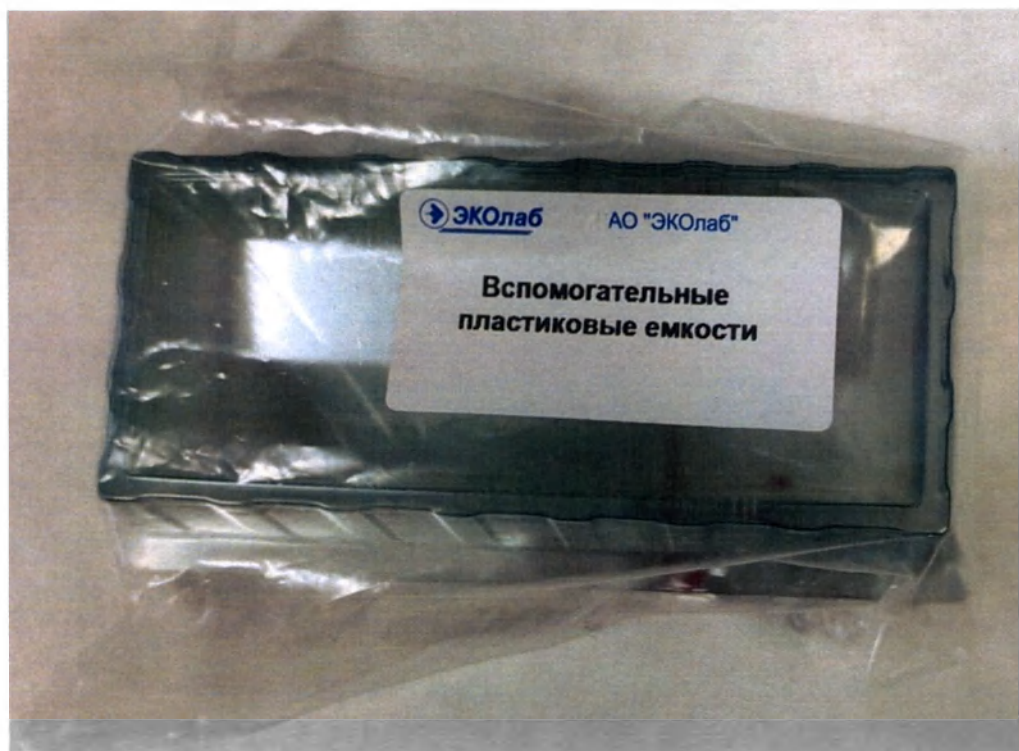


Фото вспомогательных пластиковых емкостей

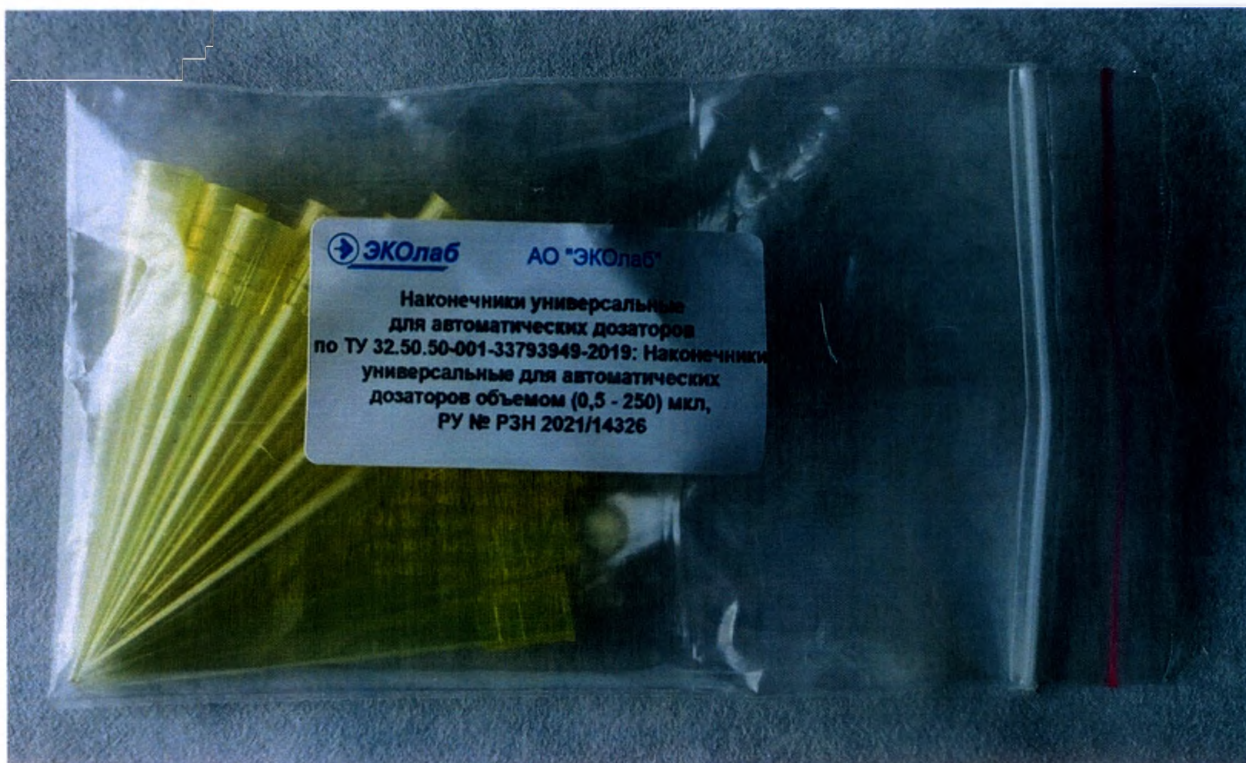


Фото Наконечников универсальных для автоматических дозаторов по ТУ 32.50.50-001-33793949-2019: Наконечники универсальные для автоматических дозаторов объемом (0,5 - 250) мкл

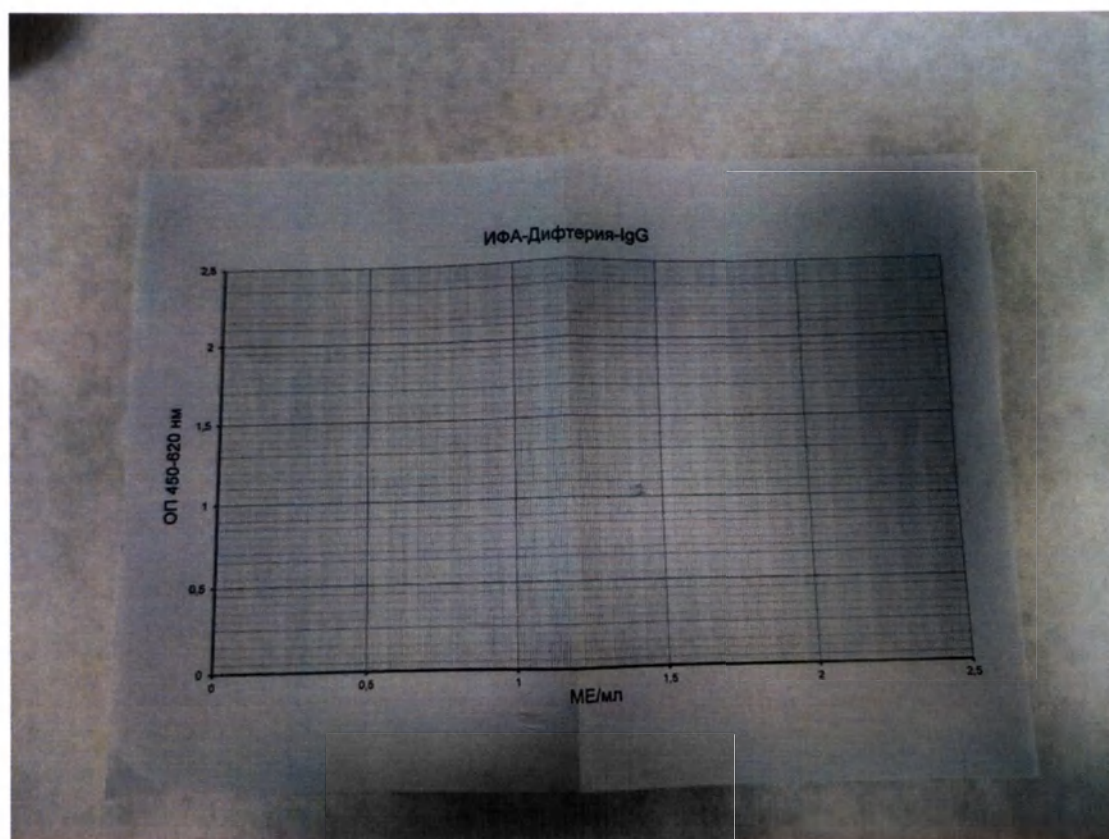


Фото бланка калибровочного графика

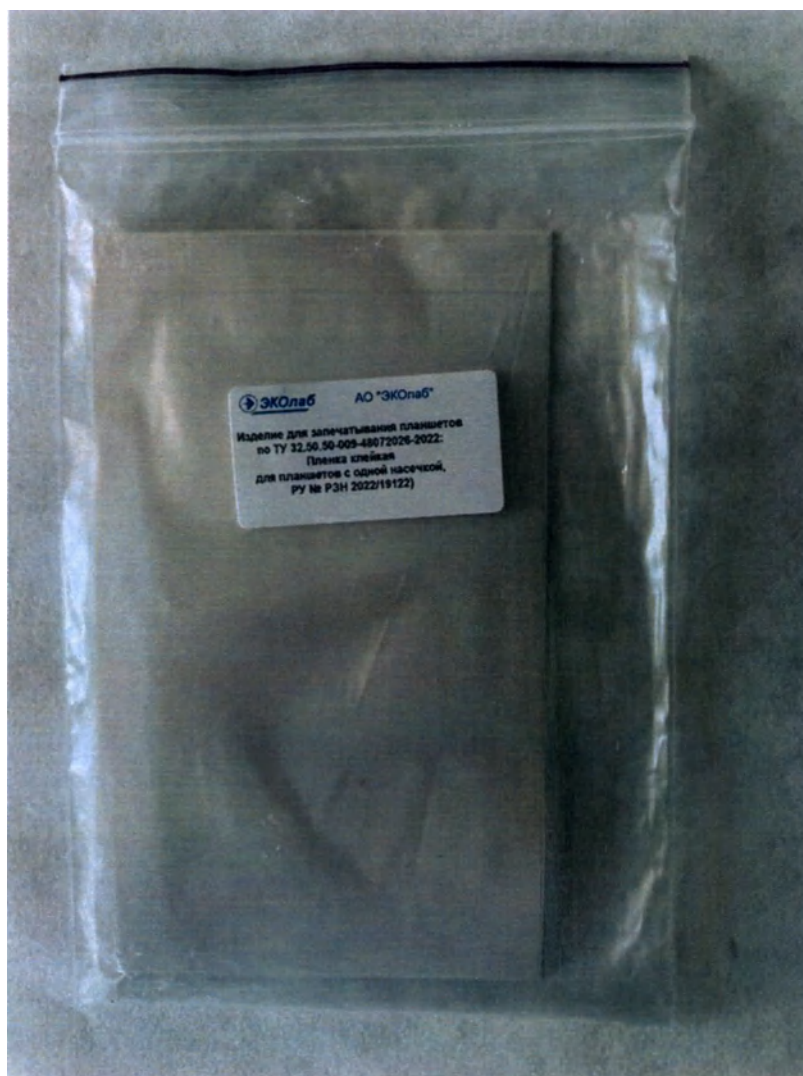


Фото изделия для запечатывания планшетов по ТУ 32.50.50-009-48072026-2022:
Пленка клейкая для планшетов с одной насечкой

**Фотографическое изображение коробки (не в сборе) набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G к
дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG" по ТУ 21.20.23-367-70423725-
2023»**

Код партии (серии): 02, дата изготовления 2023.10.17, годен до 2025.04.17

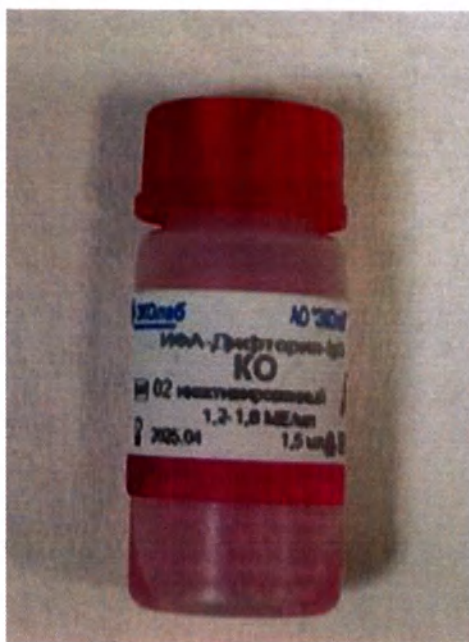


Фото компонентов набора


Код партии (серии): 02, дата изготовления 2023.10.17, годен до 2025.04.17




Иммуносорбент




Контрольный образец (КО)

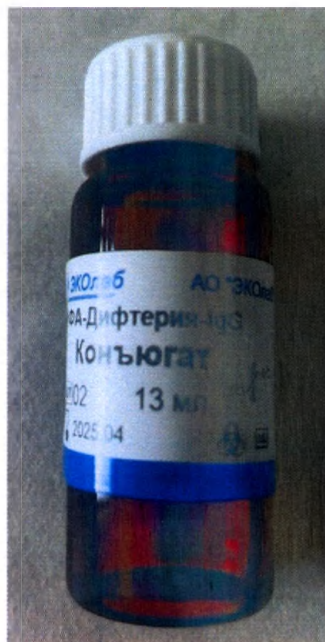

Конъюгат

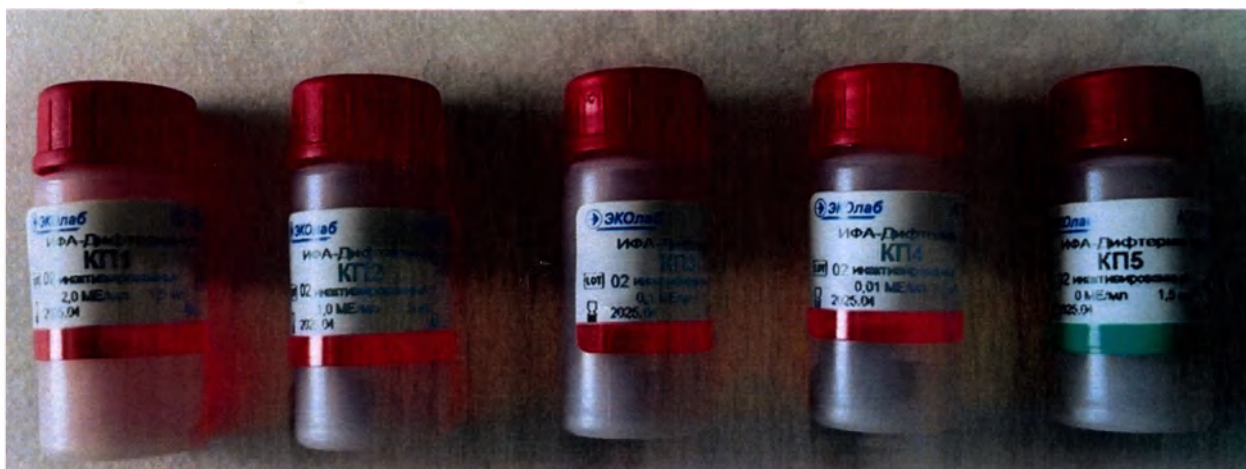


Калибровочные пробы (КП1, КП2, КП3, КП4, КП5)

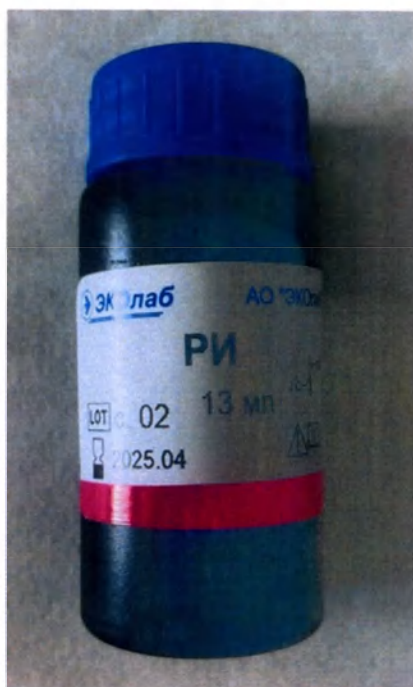


Раствор
индикаторный(РИ)




Раствор для предварительного
разведения образцов (РПРО)

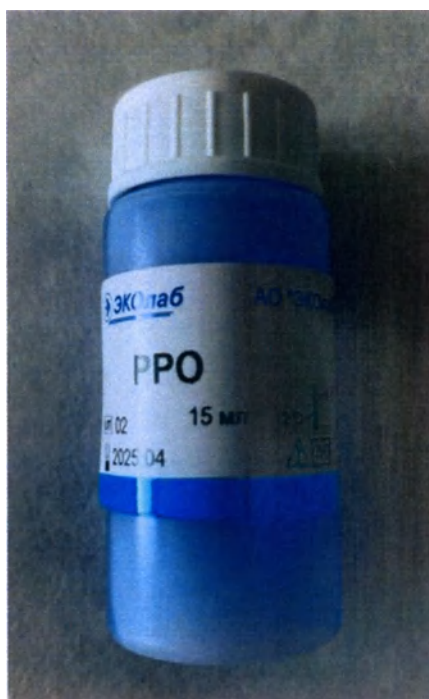

**Раствор для разведения
образцов (РРО)**

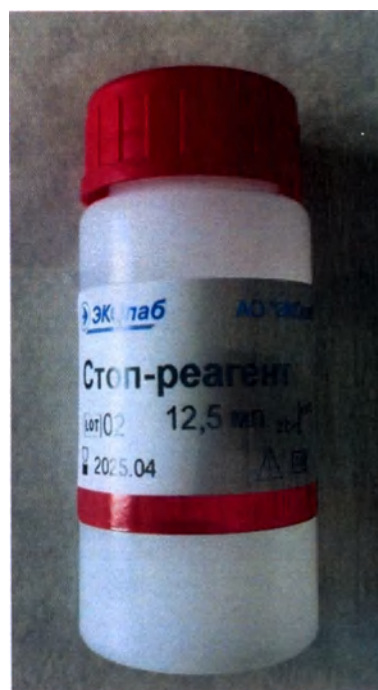

Стоп-реагент

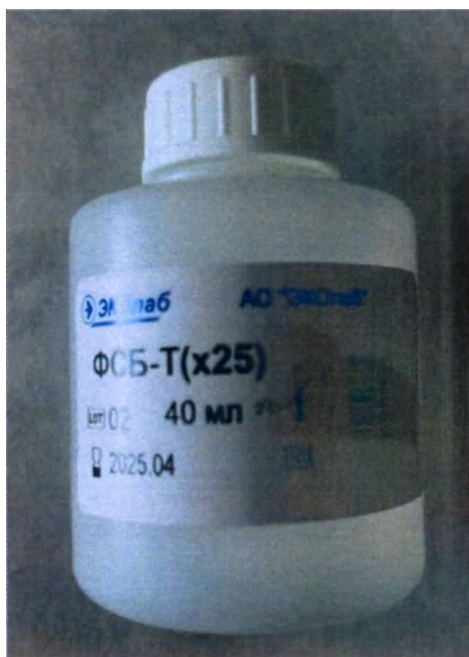

**25-кратный концентрат фосфатно-солевого
буферного раствора с твинном [ФСБ-Т(x25)]**



Фото планшета полимерного плоскостойкого для иммуноферментных исследований однократного применения Пп-"Б-М" по ТУ 9393-009-16548645-2005: разборный с фиксатором.



Фото вспомогательных пластиковых емкостей

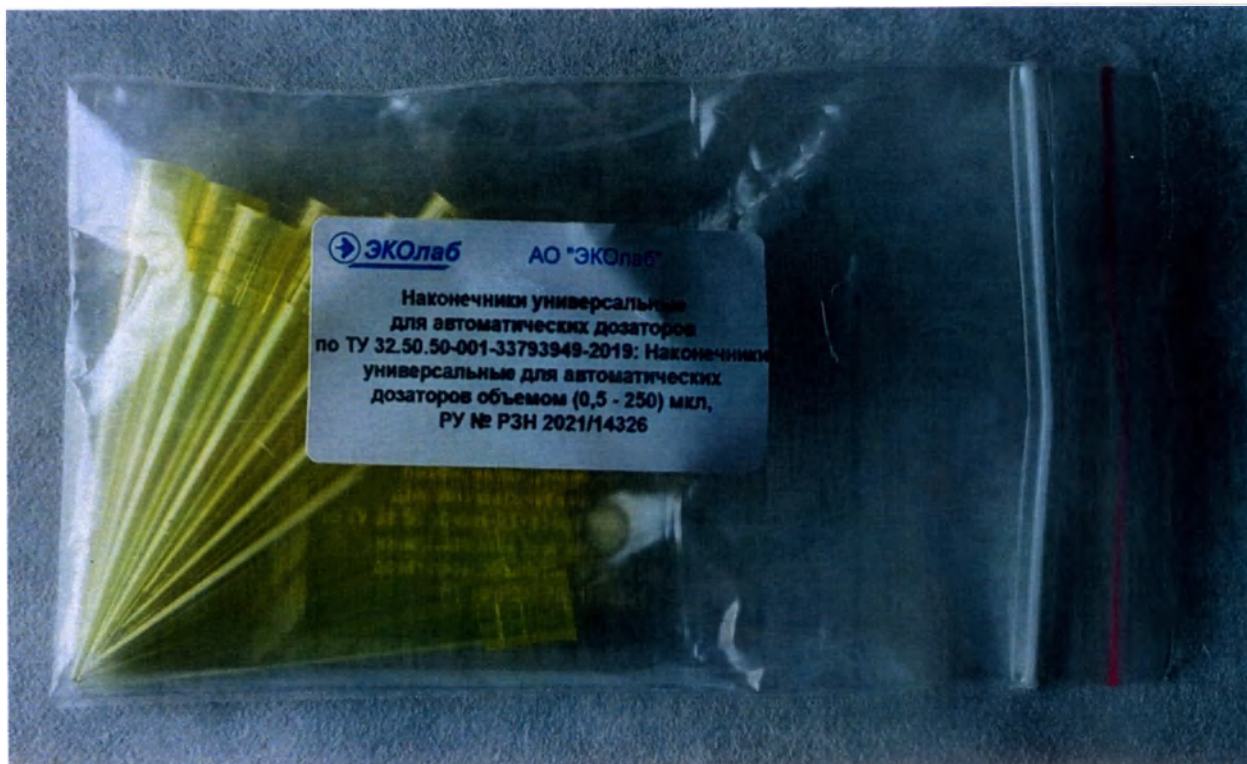


Фото Наконечников универсальных для автоматических дозаторов по ТУ 32.50.50-001-33793949-2019: Наконечники универсальные для автоматических дозаторов объемом (0,5 - 250) мкл

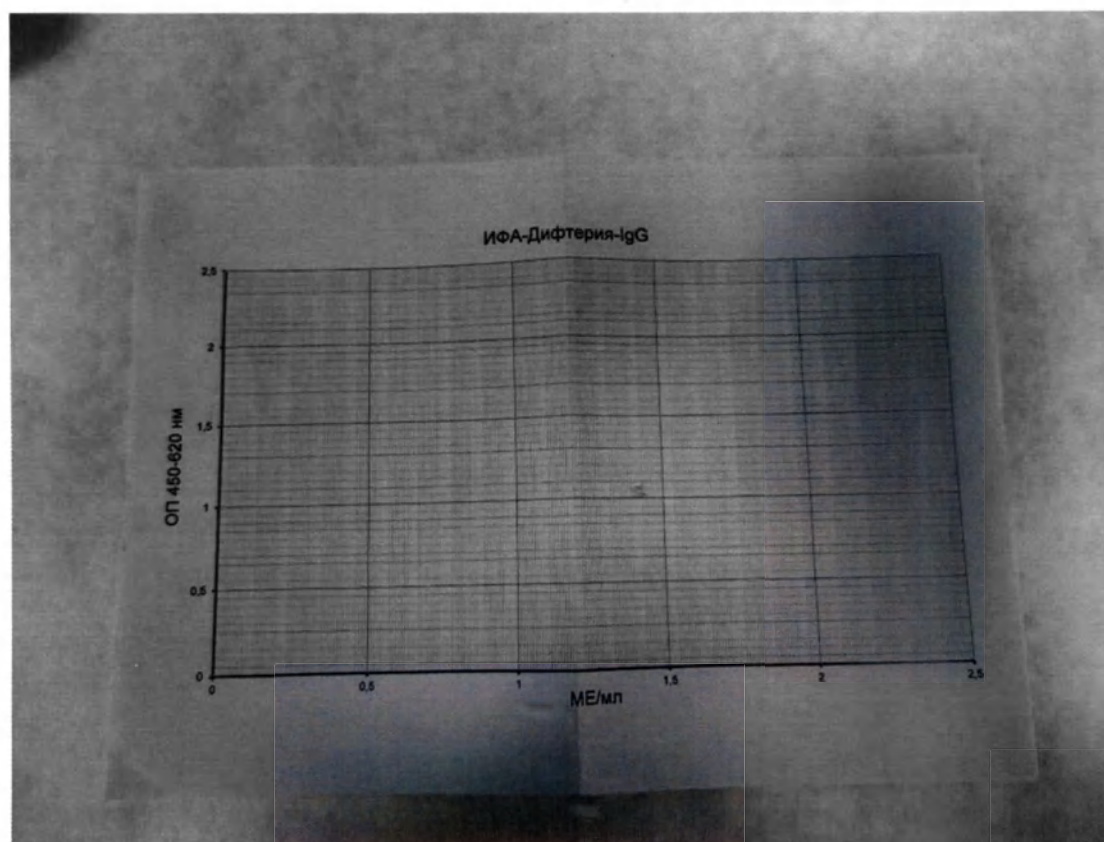


Фото бланка калибровочного графика



Фото изделия для запечатывания планшетов по ТУ 32.50.50-009-48072026-2022:
Пленка клейкая для планшетов с одной насечкой

Фотографическое изображение транспортной тары Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину» "ИФА-Дифтерия-IgG" по ТУ 21.20.23-367-70423725-2023»



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 лист 06

Ген. директор АО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"06" 06 2024 г.

