



Общество с ограниченной ответственностью «РЕАН»
тел./факс (495) 374-77-56
www.reanmed.ru info@reanmed.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕАН»



Чернышев В.Ю.

«26» февраля 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система для видеоларингоскопии» в вариантах исполнения


1 Видеоларингоскоп BD-DF, в составе:
1.1 Монитор 3 дюйма




1.2 Клинок видеоларингоскопа, тип Миллер (Miller), размер 0 (MIL0)

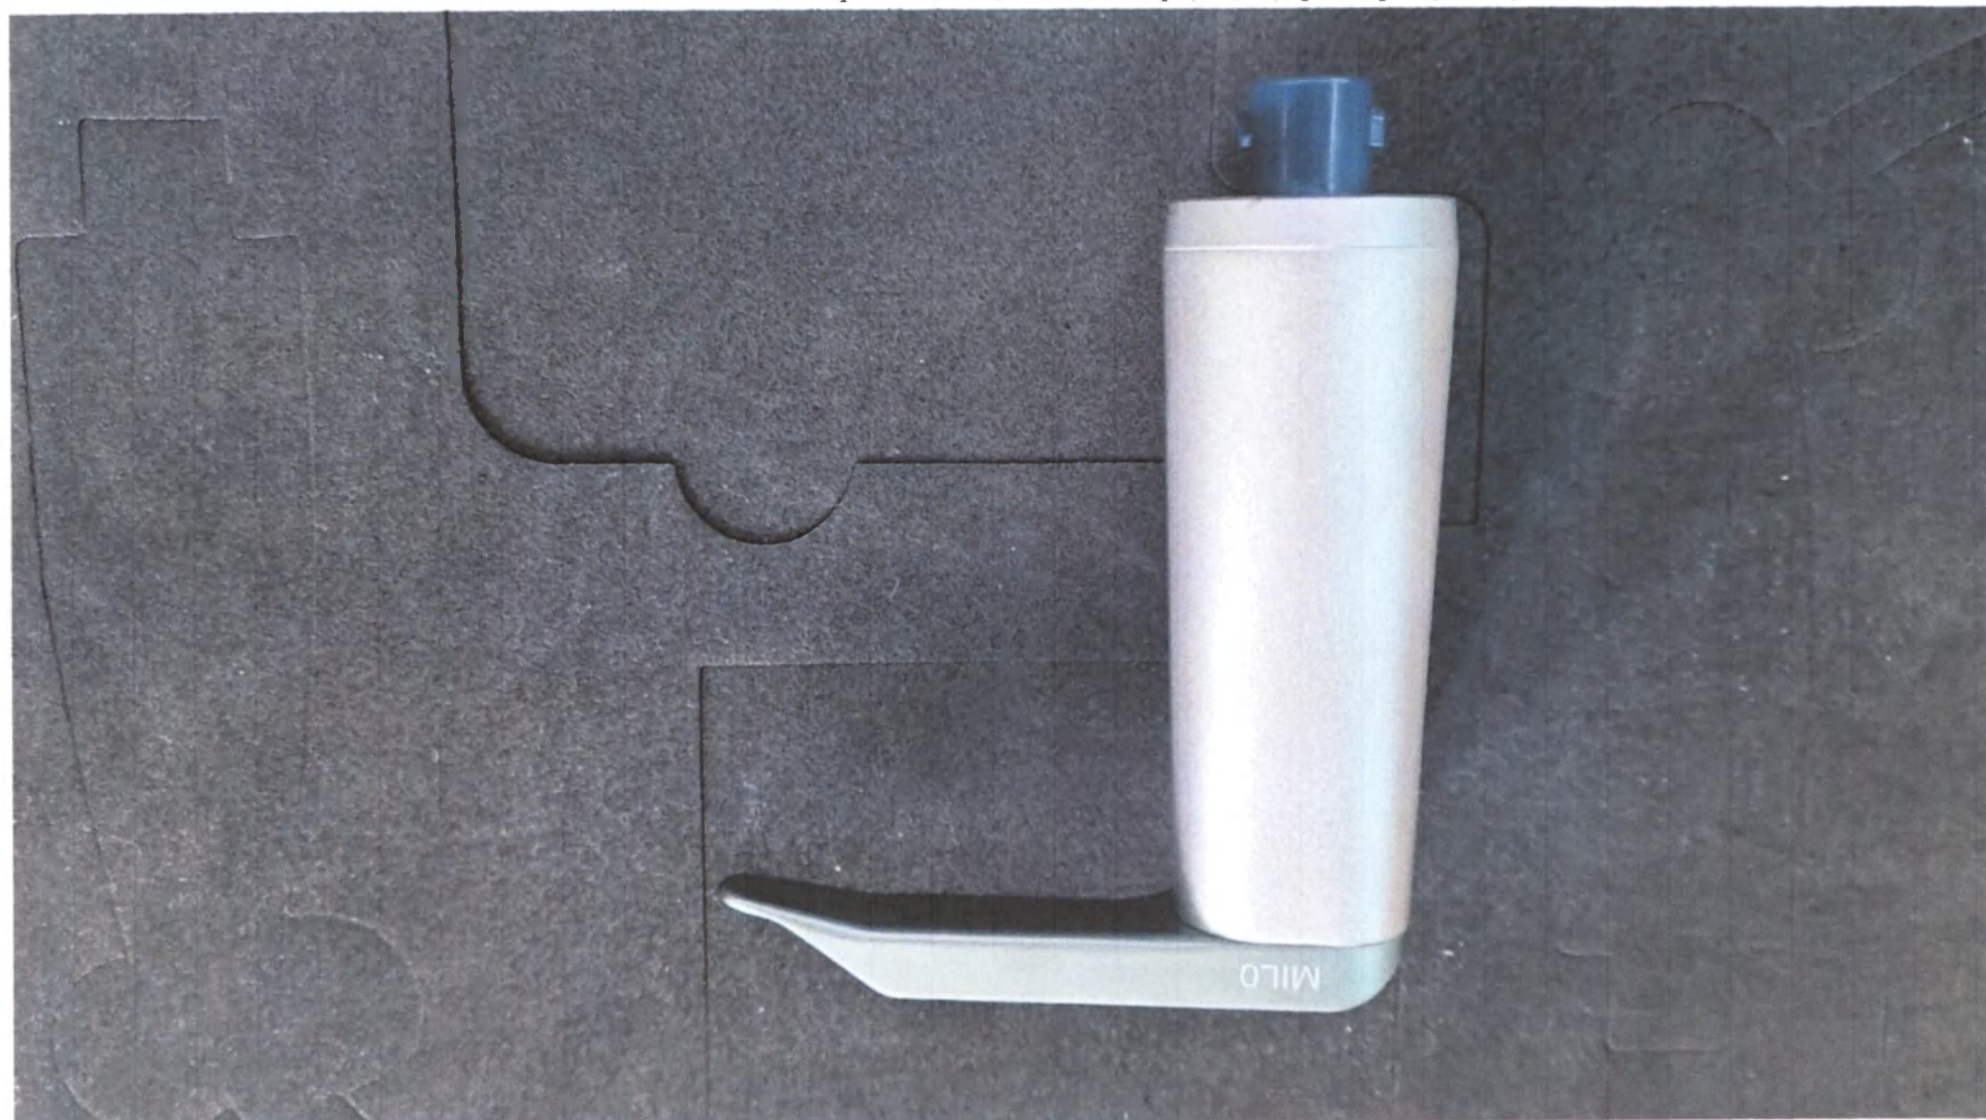

1.3 Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 1 (MAC1)

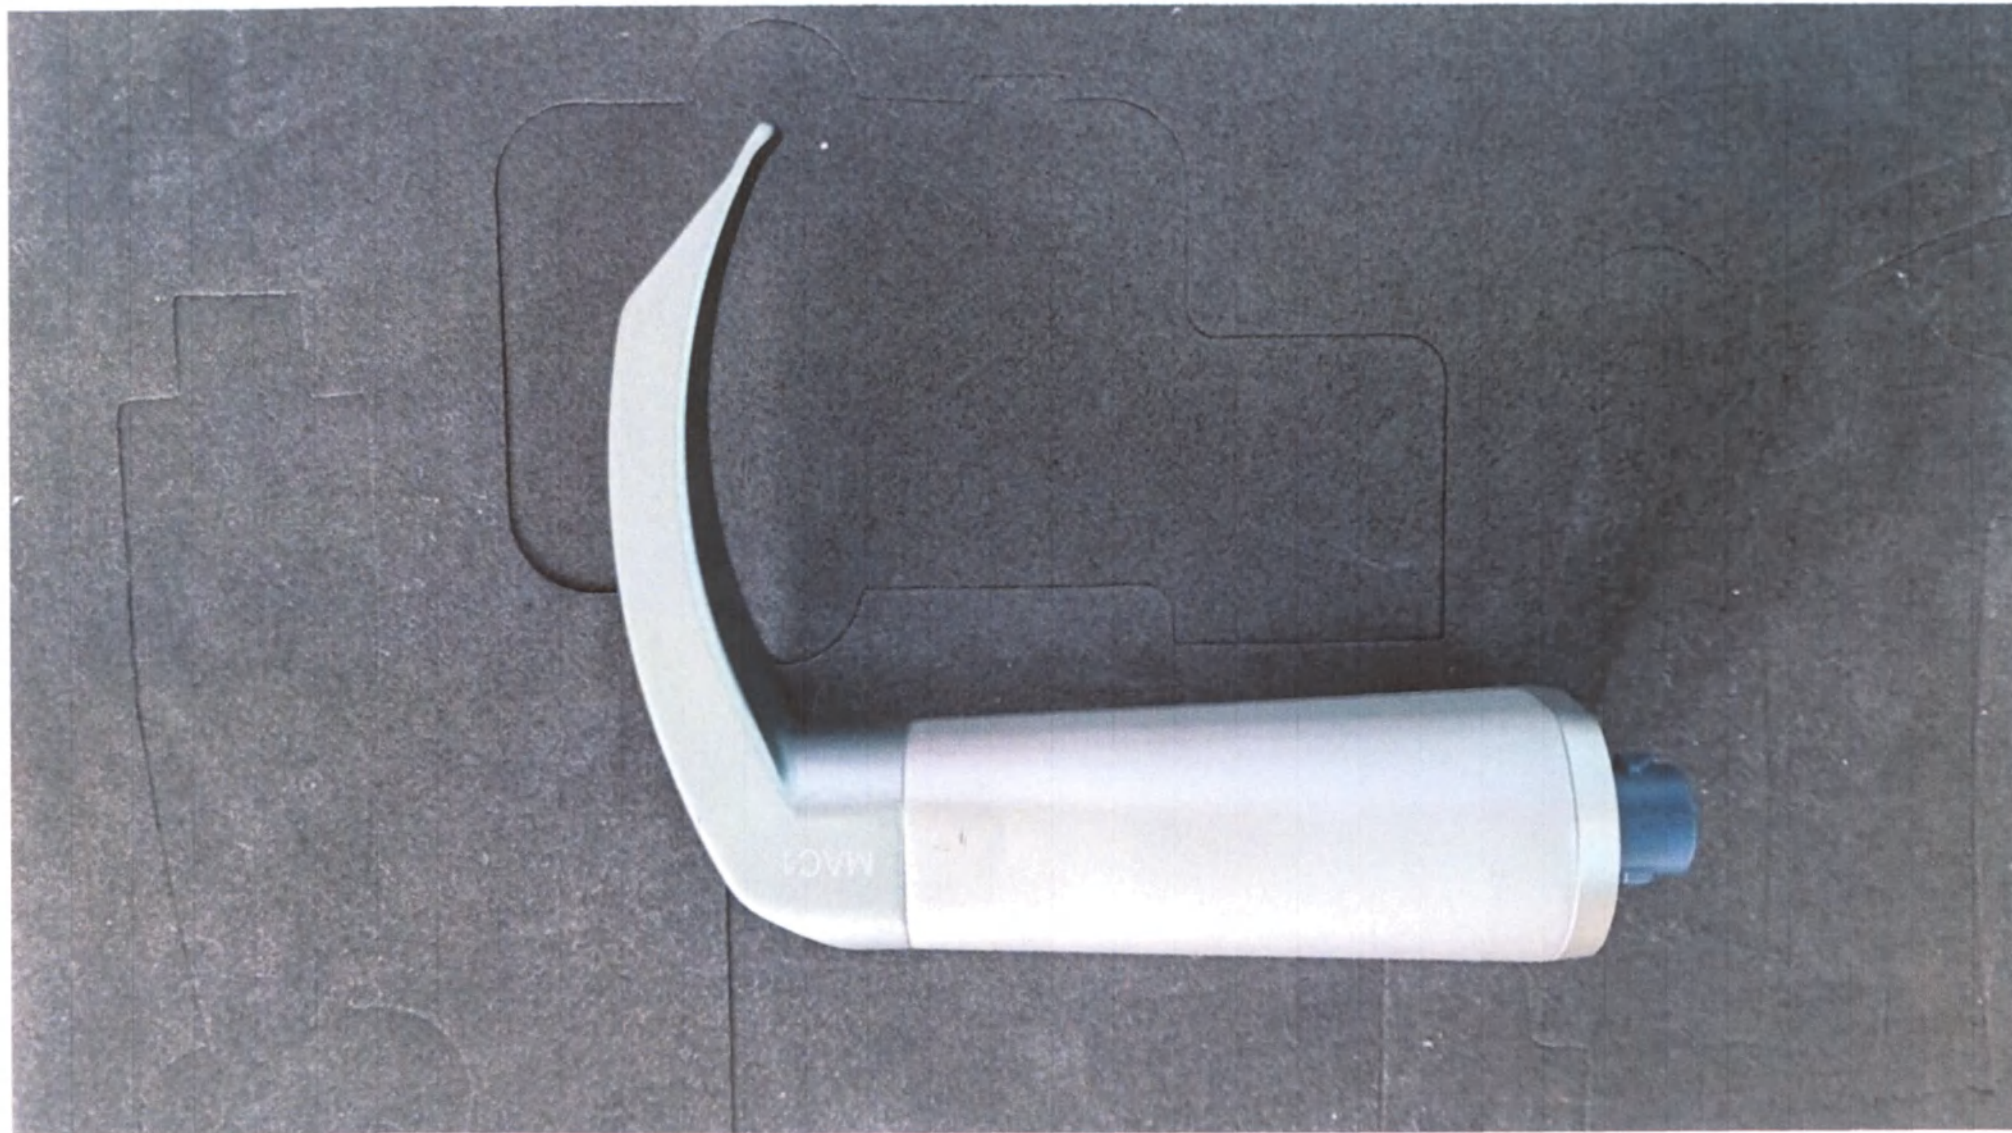


1.4 Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 2 (MAC2)

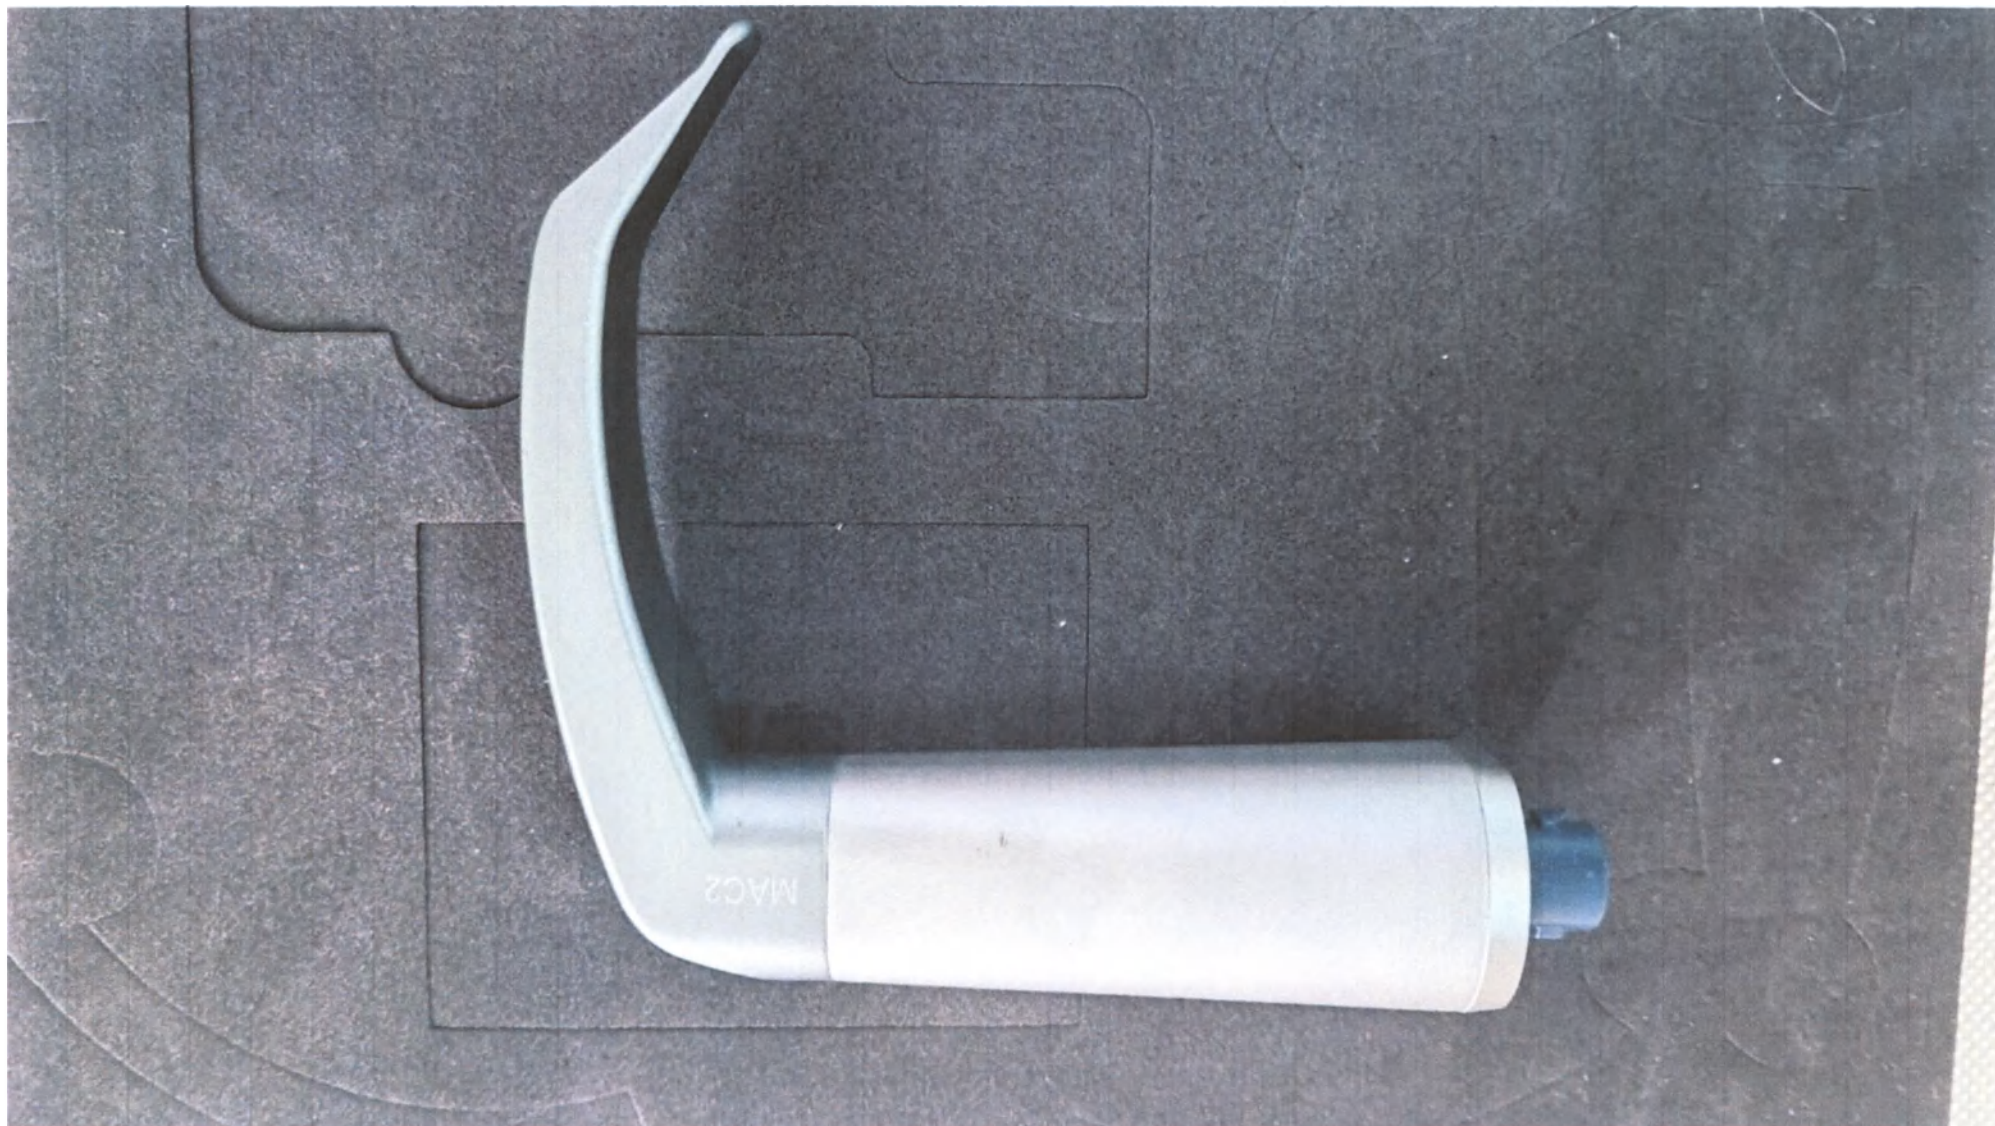


1.5 Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 3 (MAC3)




1.6 Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 4 (MAC4)

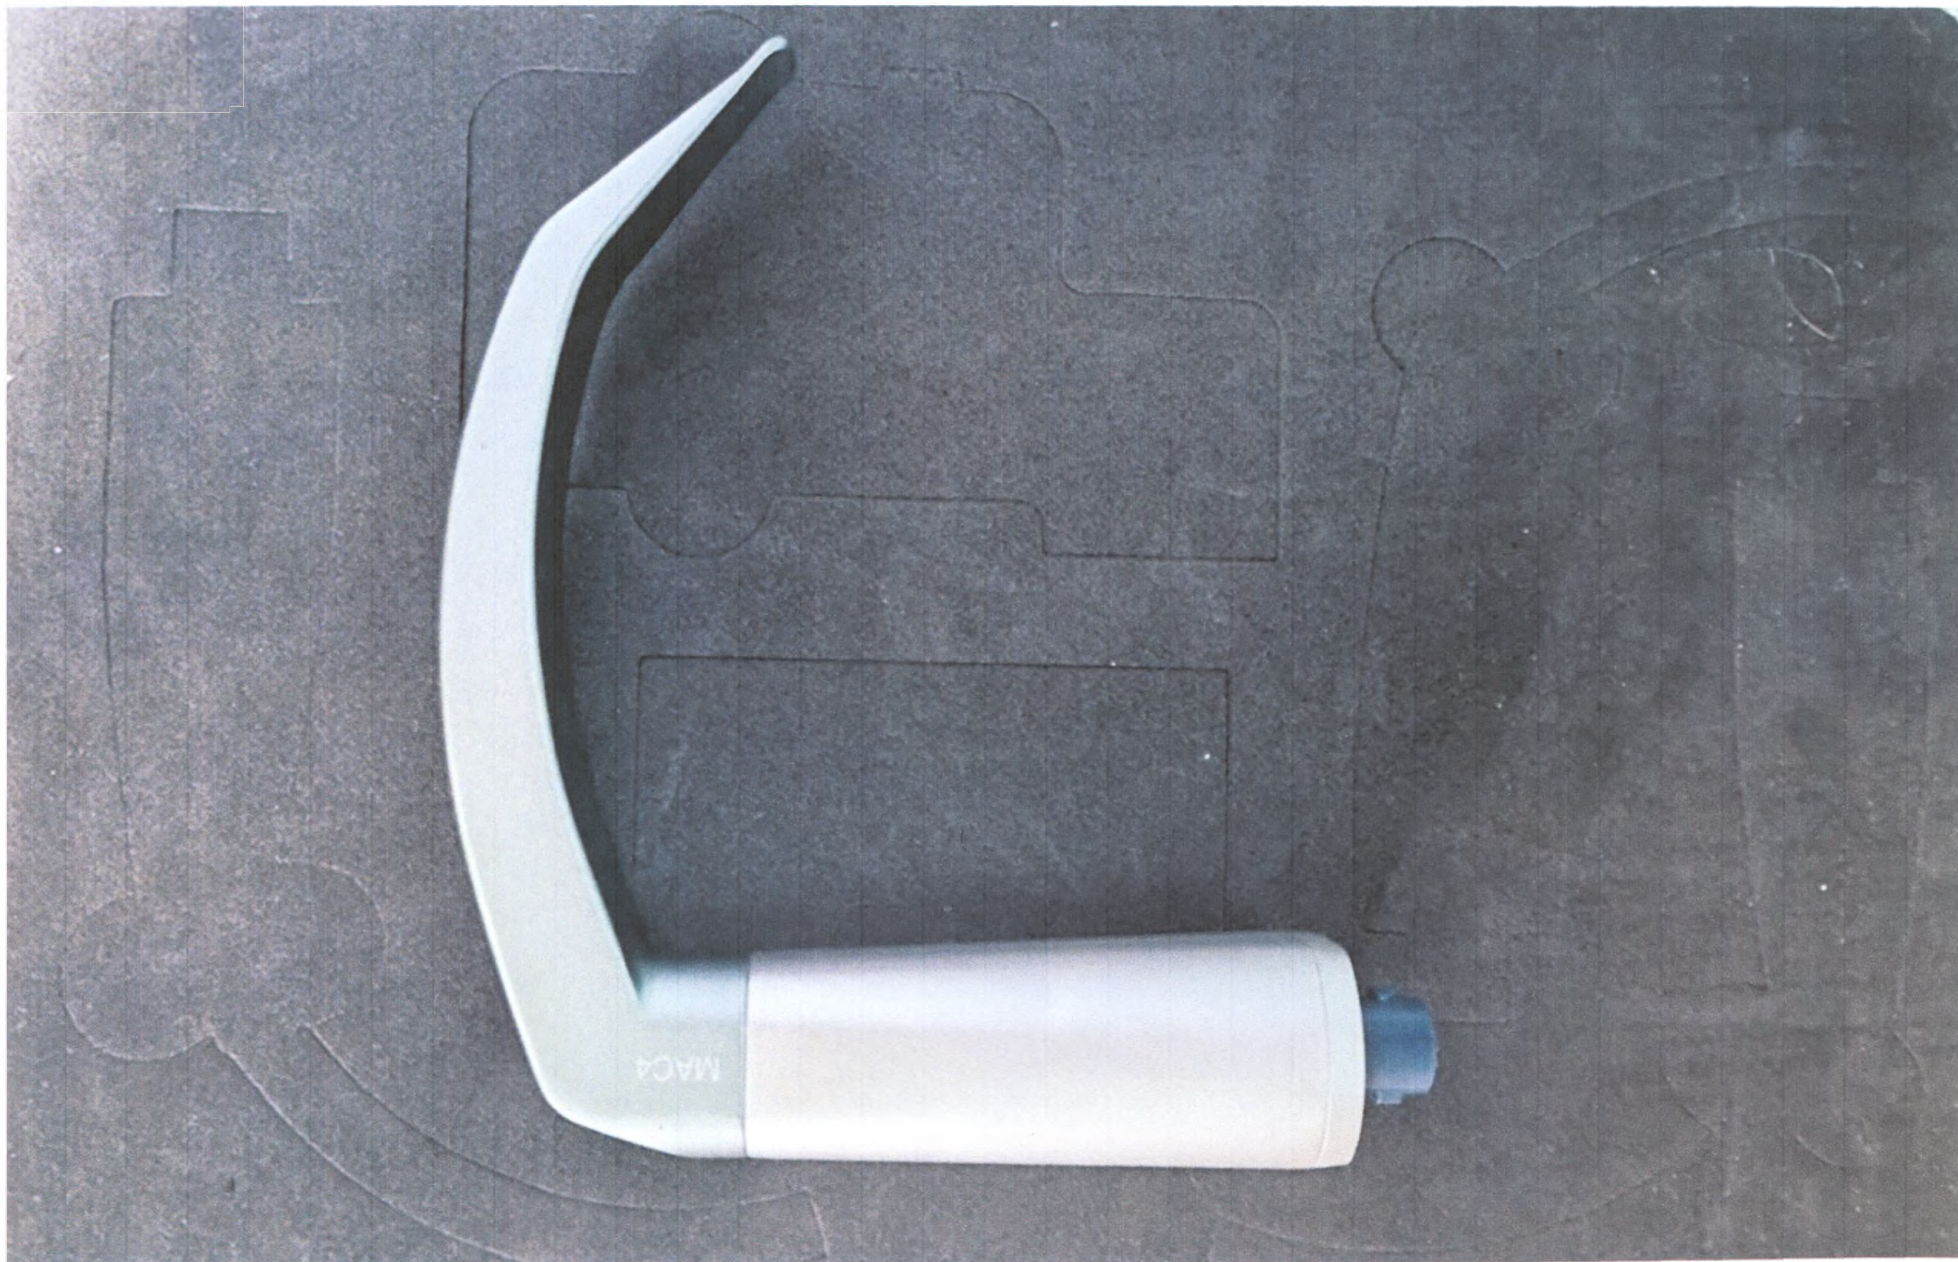


1.7 Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), для трудных дыхательных путей, D-BLADE

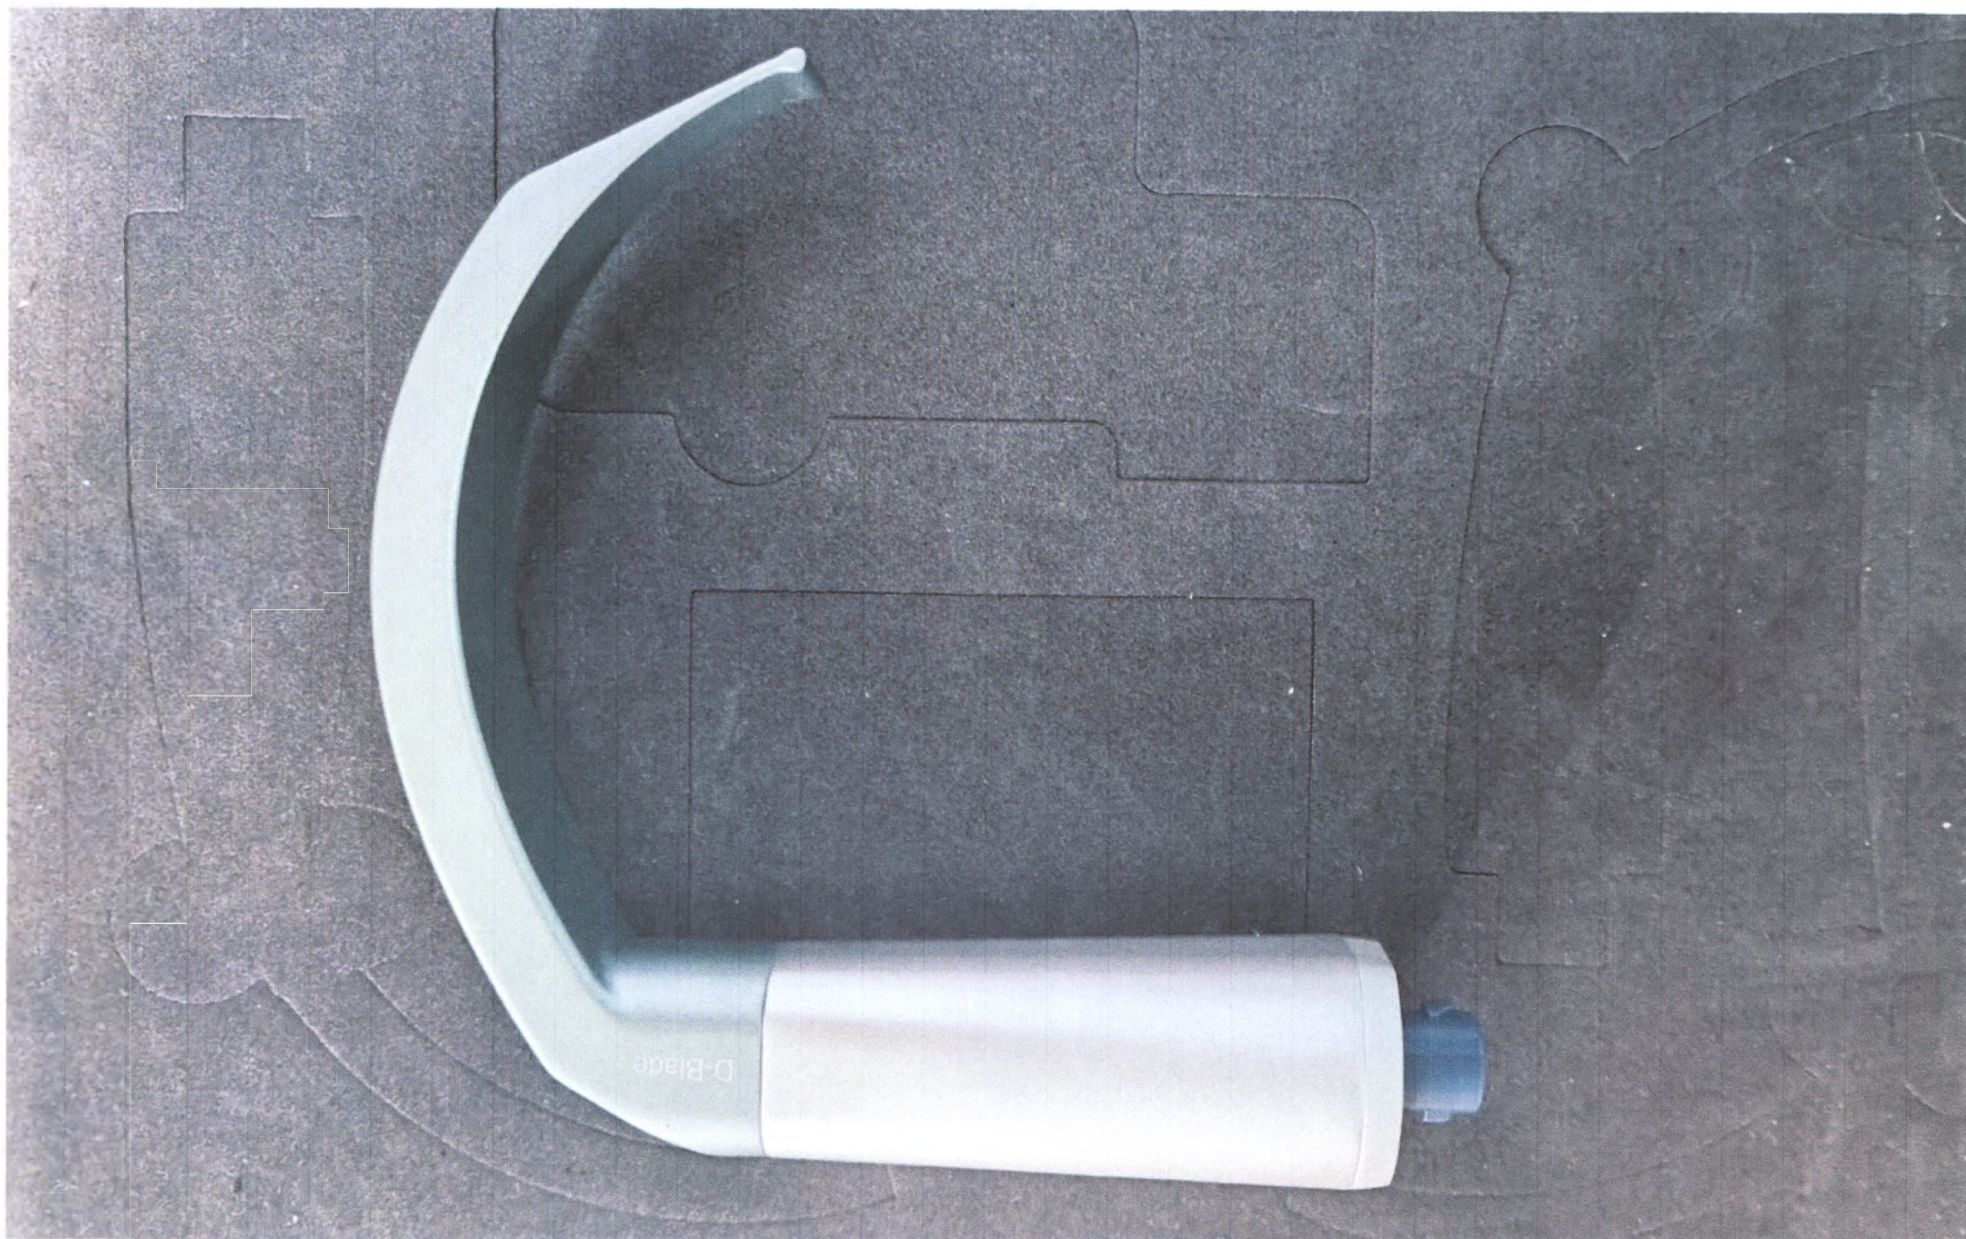

1.8 Защитный колпачок

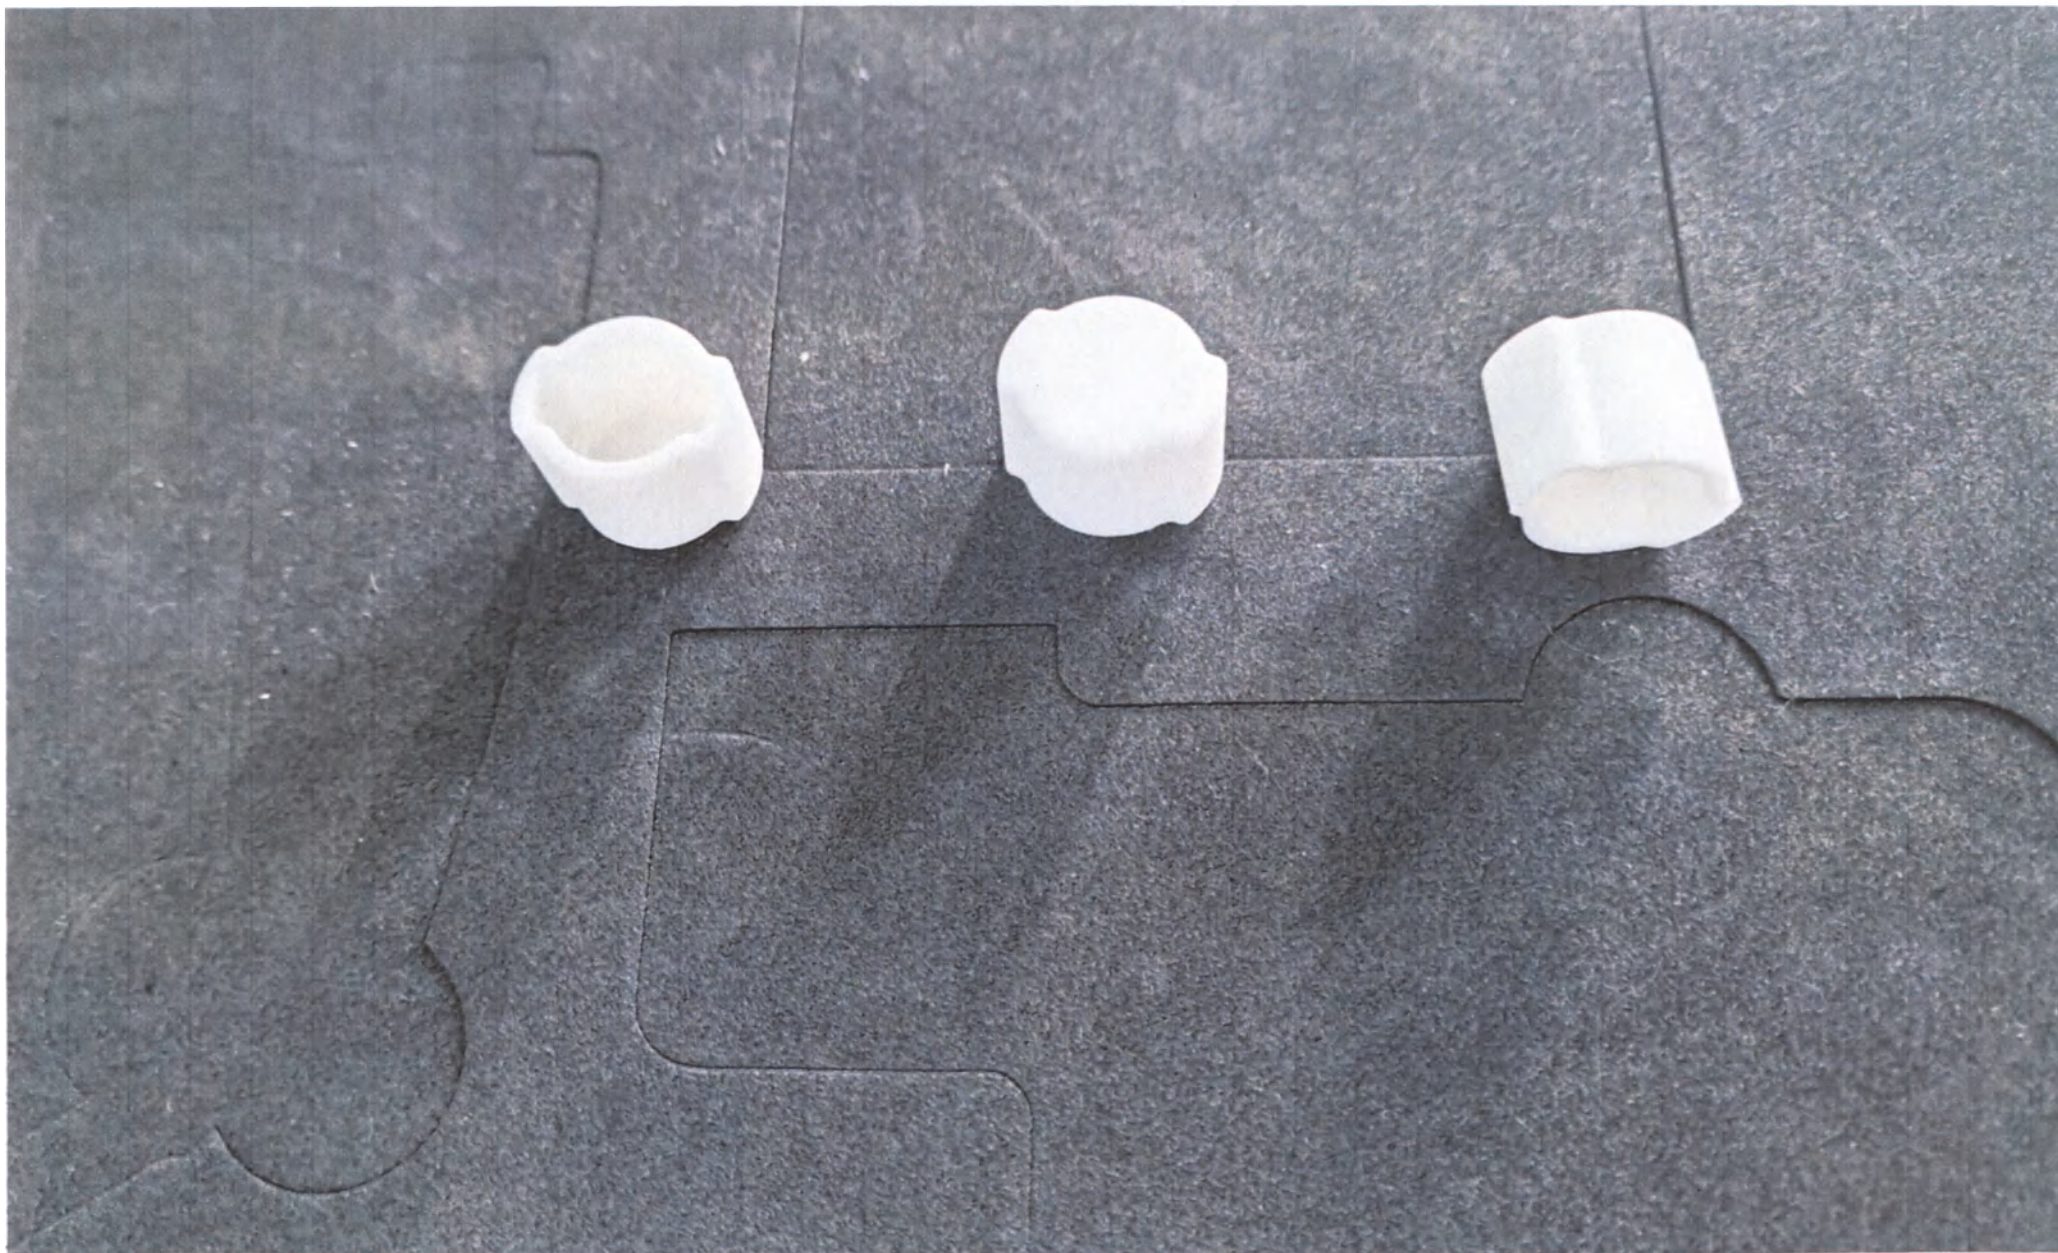


1.9 Сетевое зарядное устройство с кабелем USB

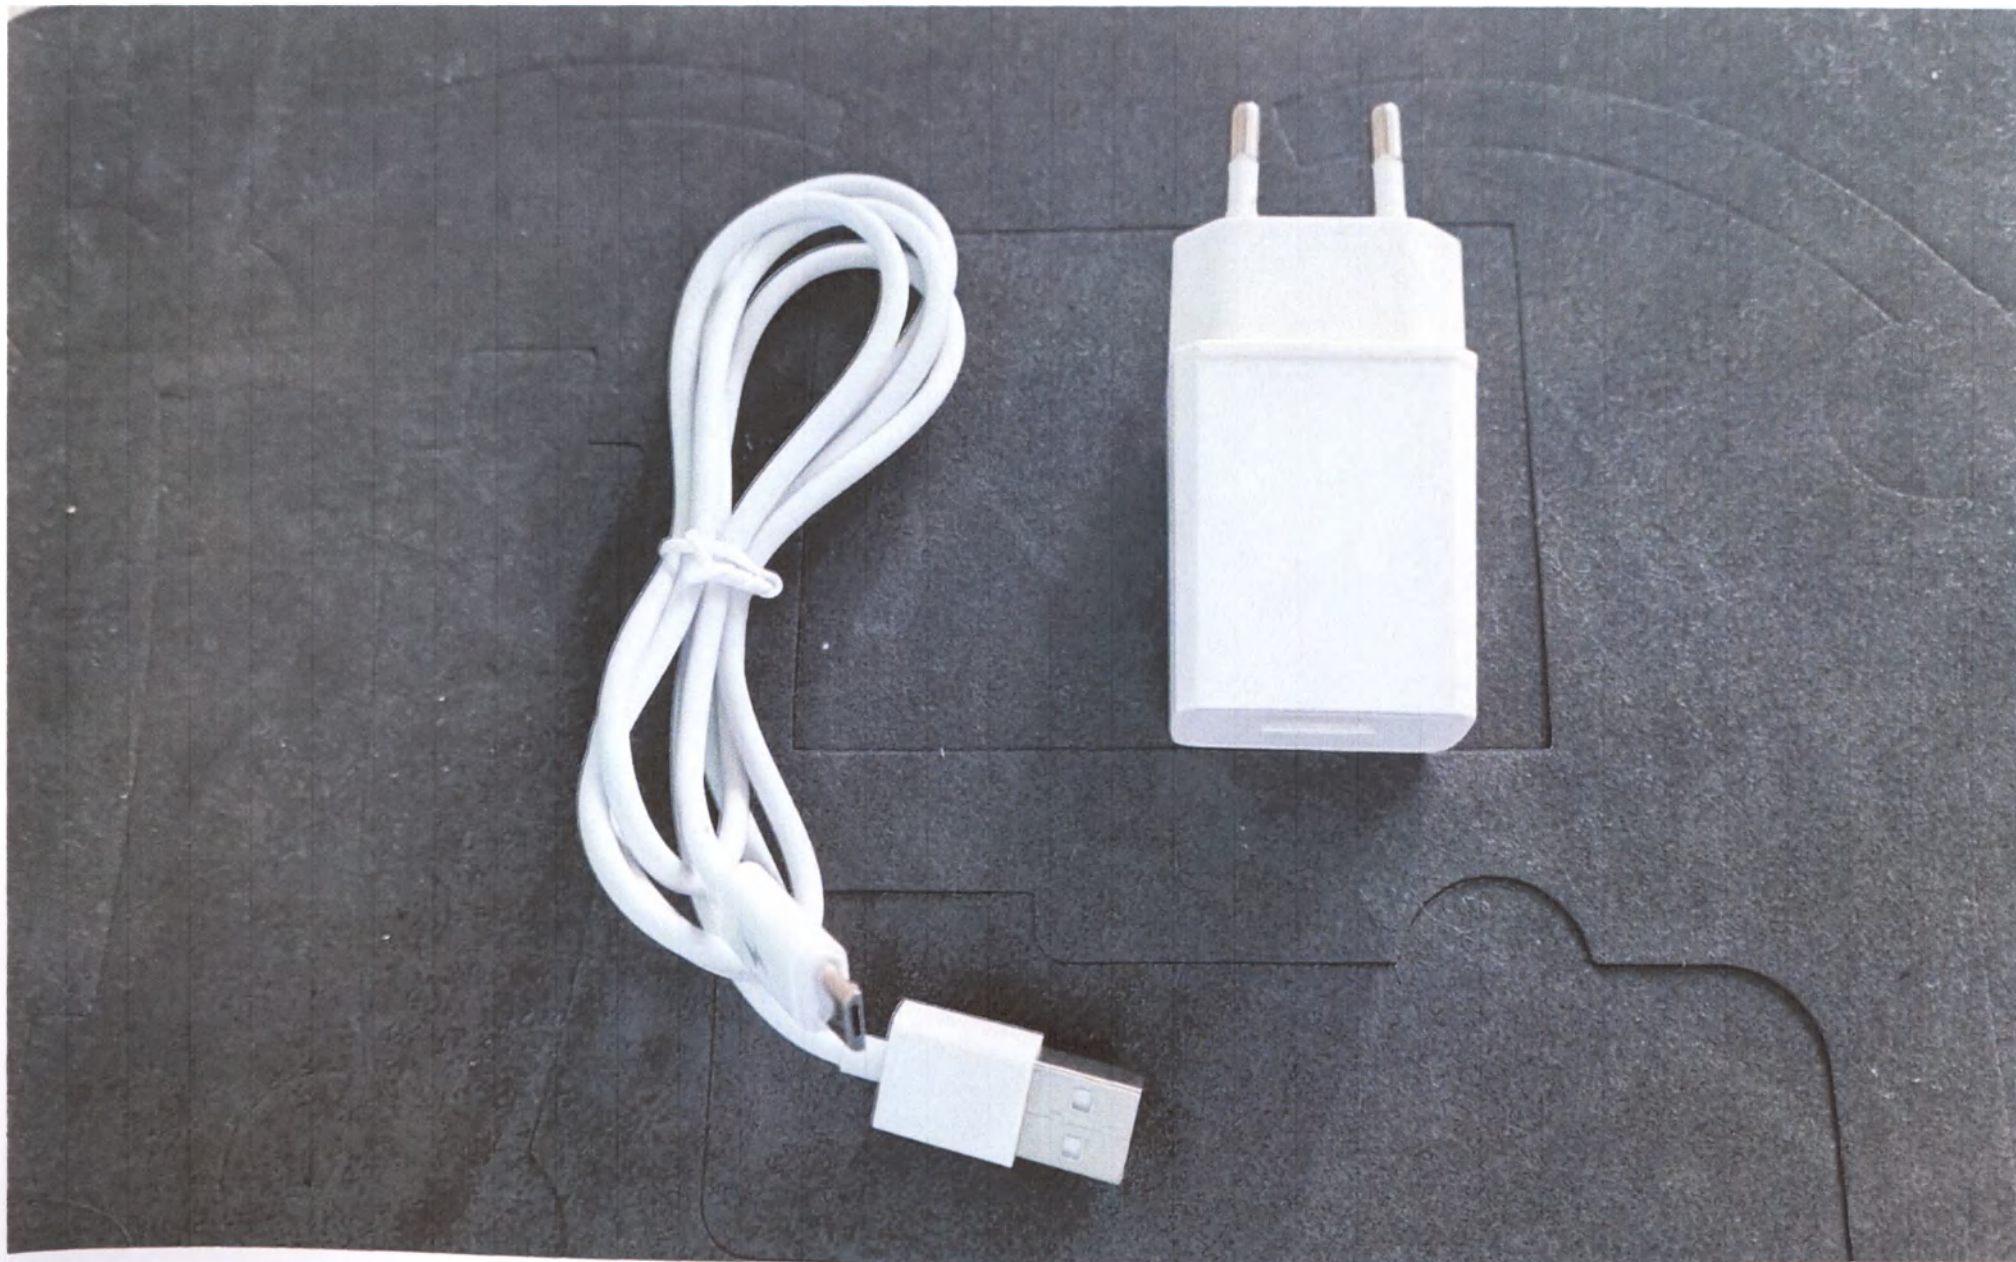


2 Видеоларингоскоп BD-DP, в составе:
2.1 Монитор 3 дюйма




2.2 Рукоятка видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh)

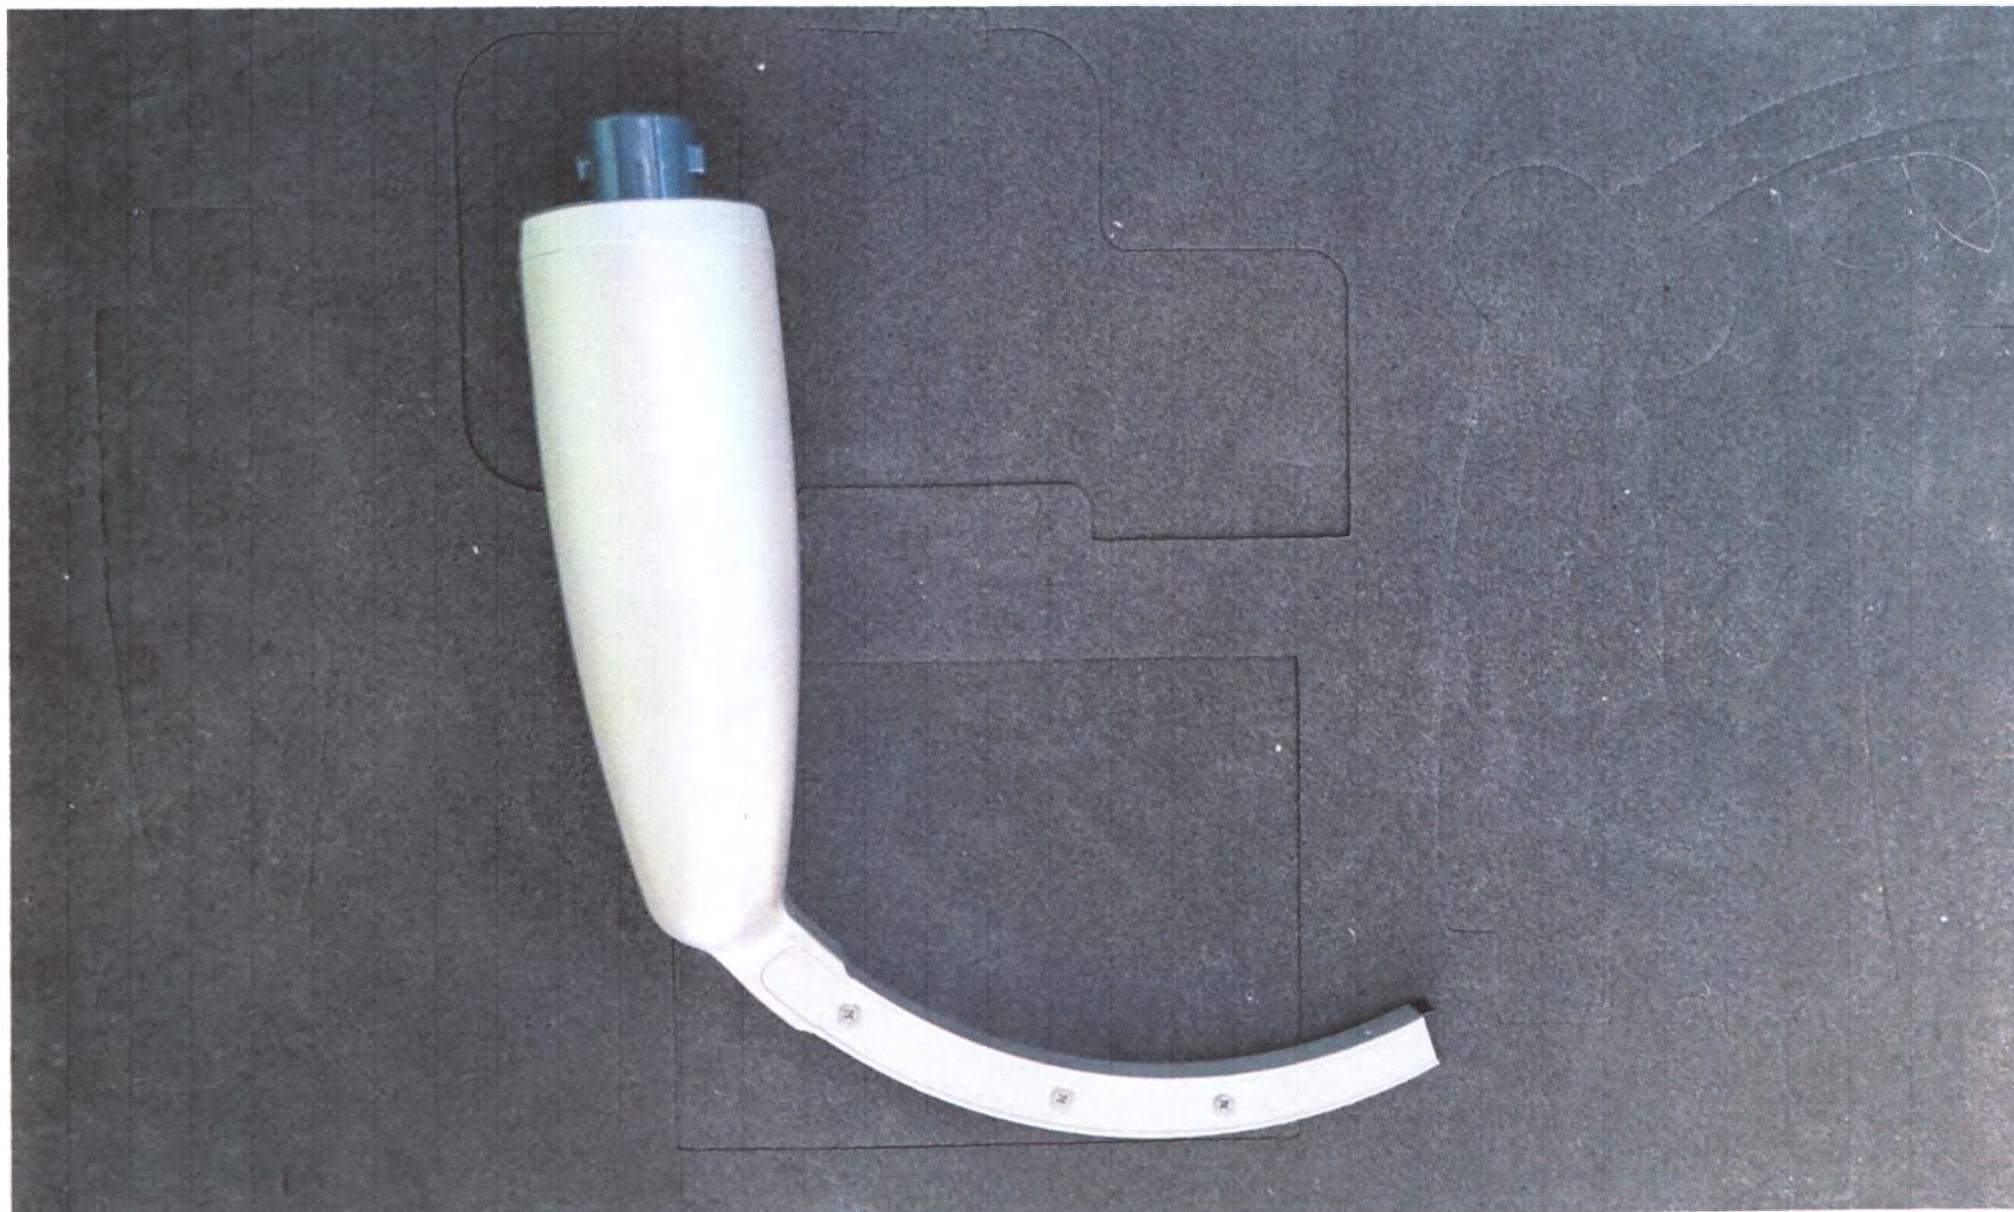


2.3 Рукоятка видеоларингоскопа, тип Миллер (Miller)

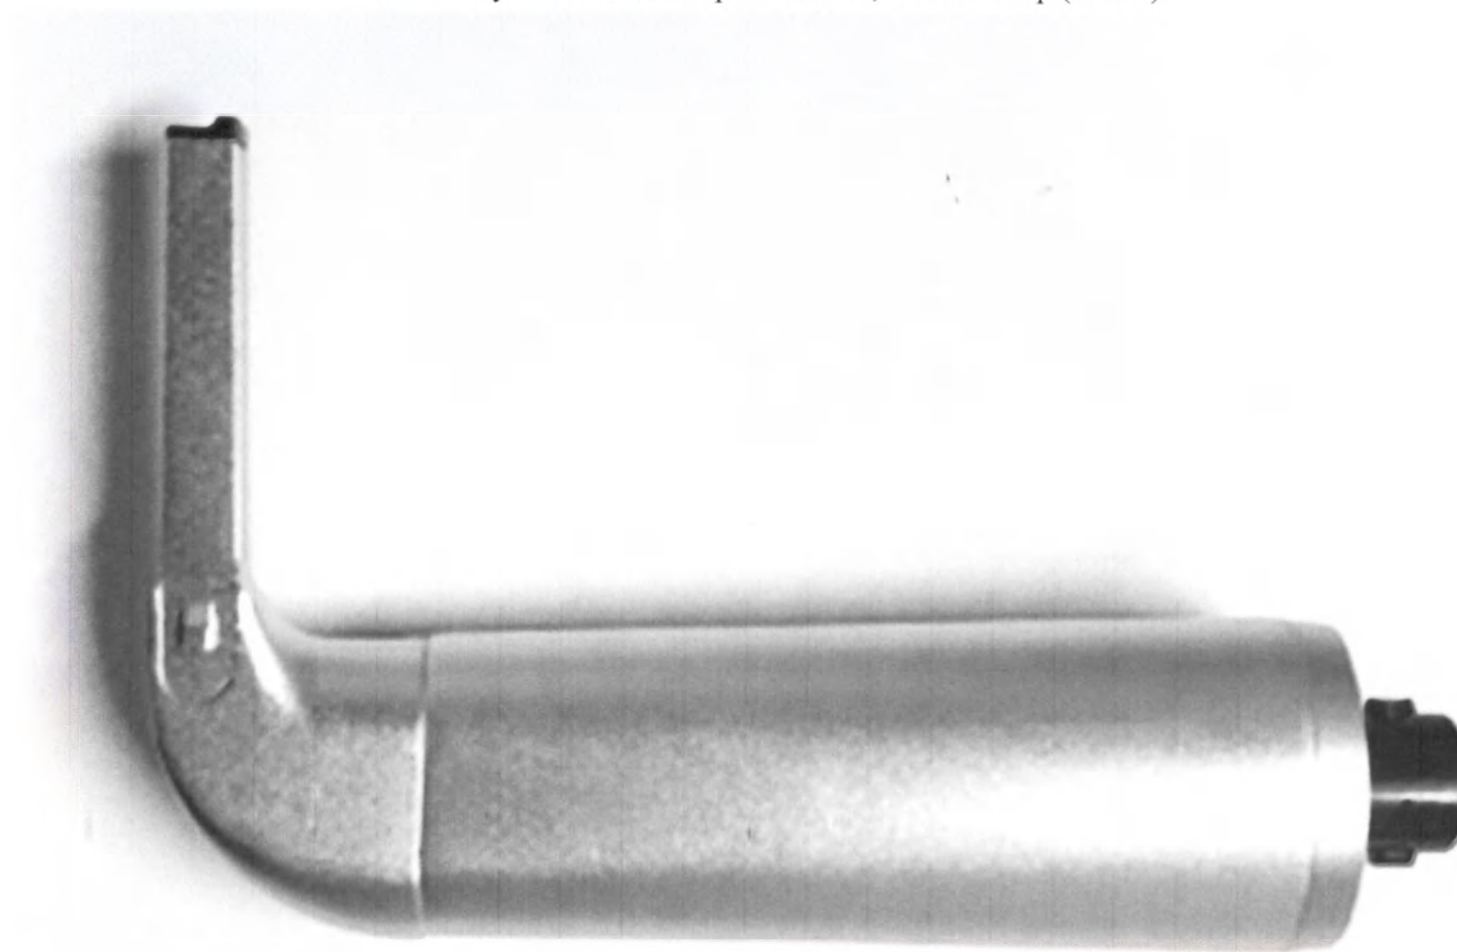


2.4 Клинок видеоларингоскопа, одноразовый, тип Макинтош (Macintosh), размер 1 (MAC1)

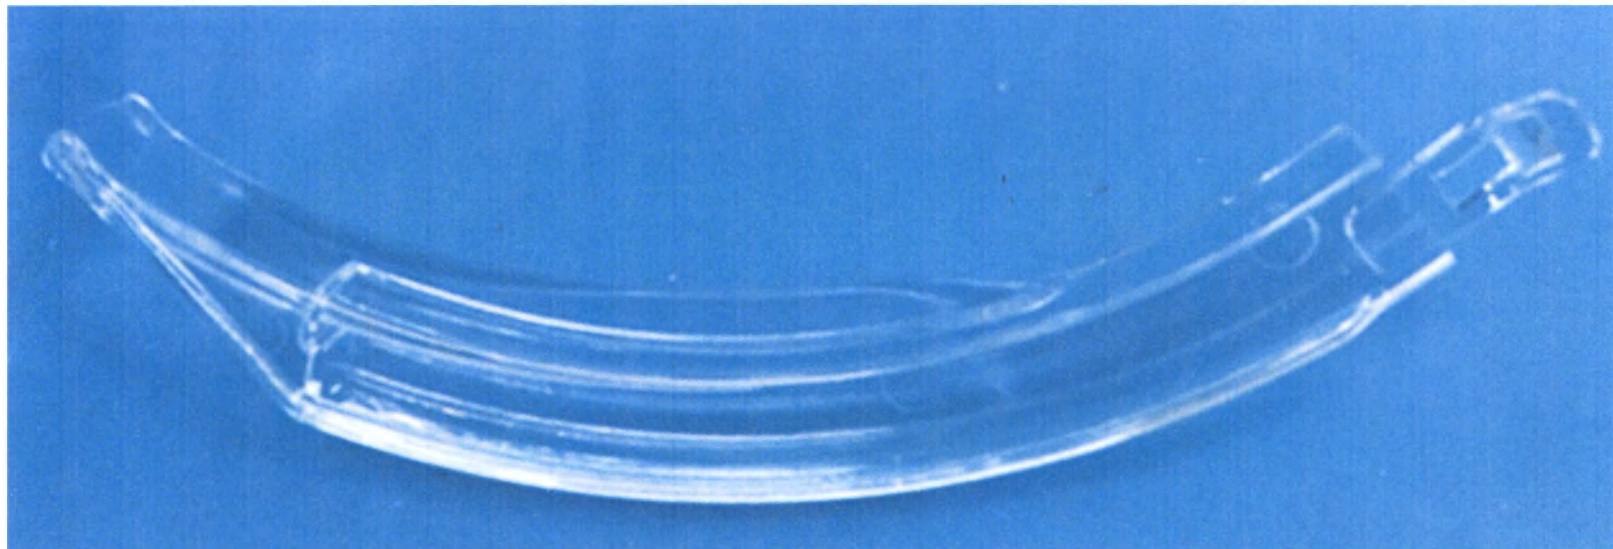


2.5 Клинок видеоларингоскопа, одноразовый, тип Макинтош (Macintosh), размер 3 (MAC3)

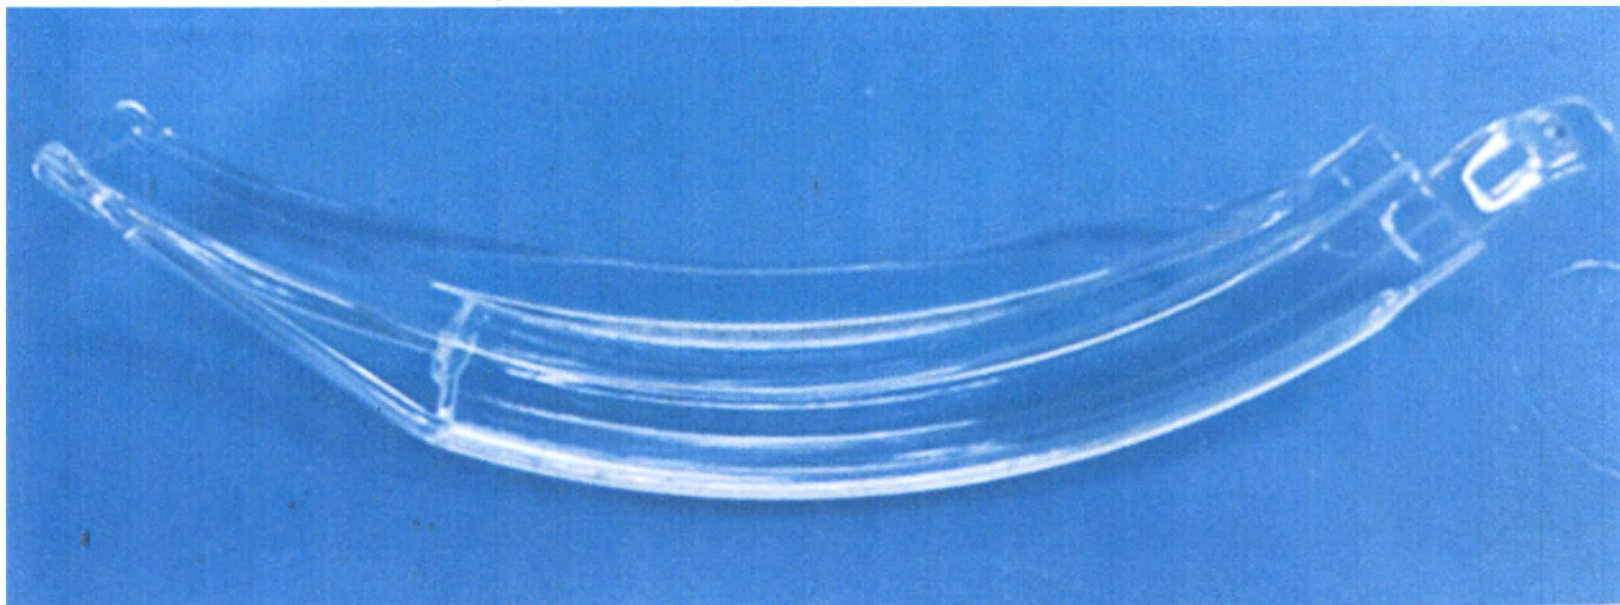


2.6 Клинок видеоларингоскопа, одноразовый, тип Макинтош (Macintosh), размер 4 (MAC4)

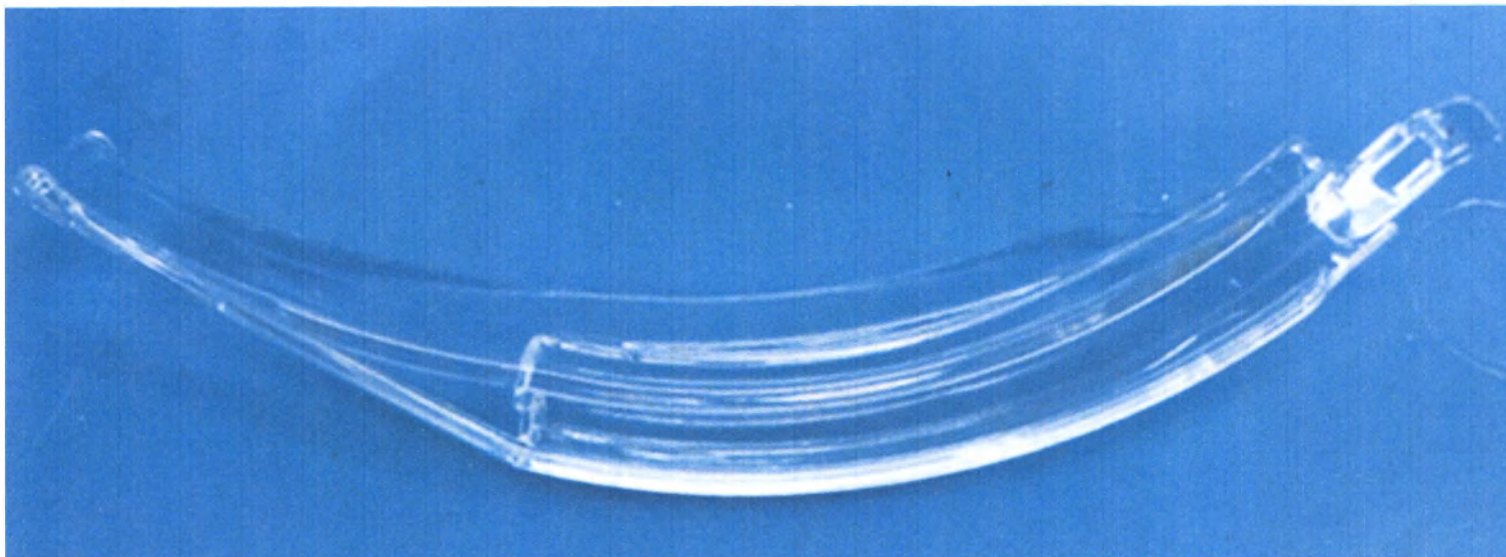

2.7 Клинок видеоларингоскопа, одноразовый, тип Миллер (Miller), размер 0 (MIL0)

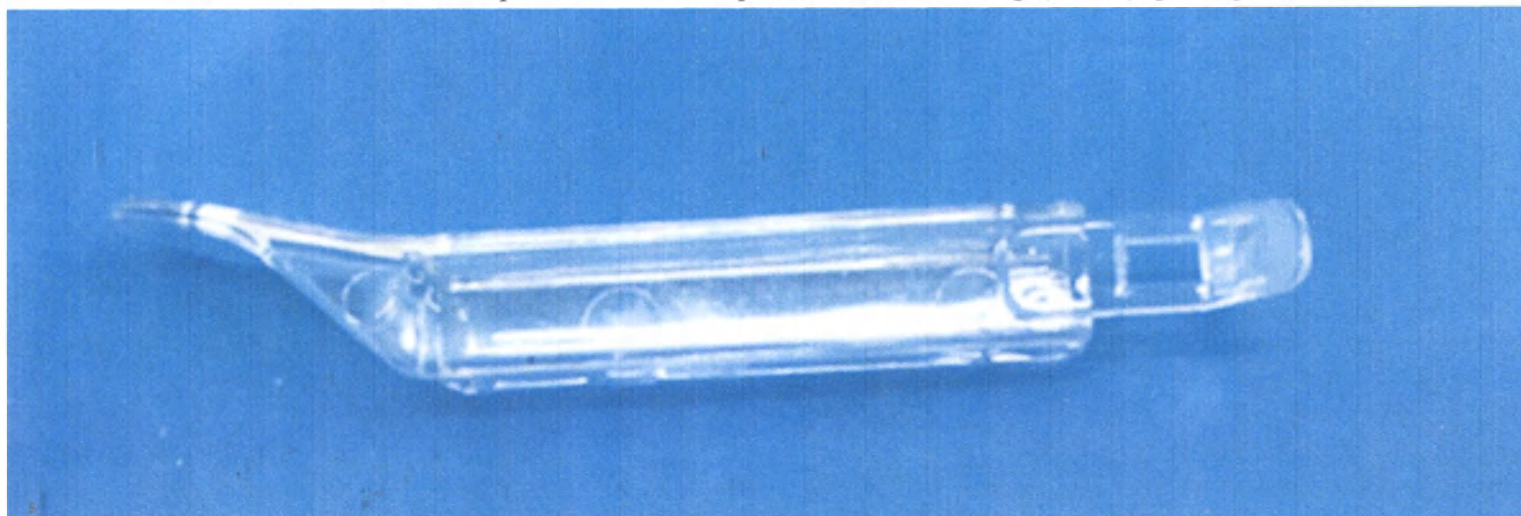


2.8 Сетевое зарядное устройство с кабелем USB

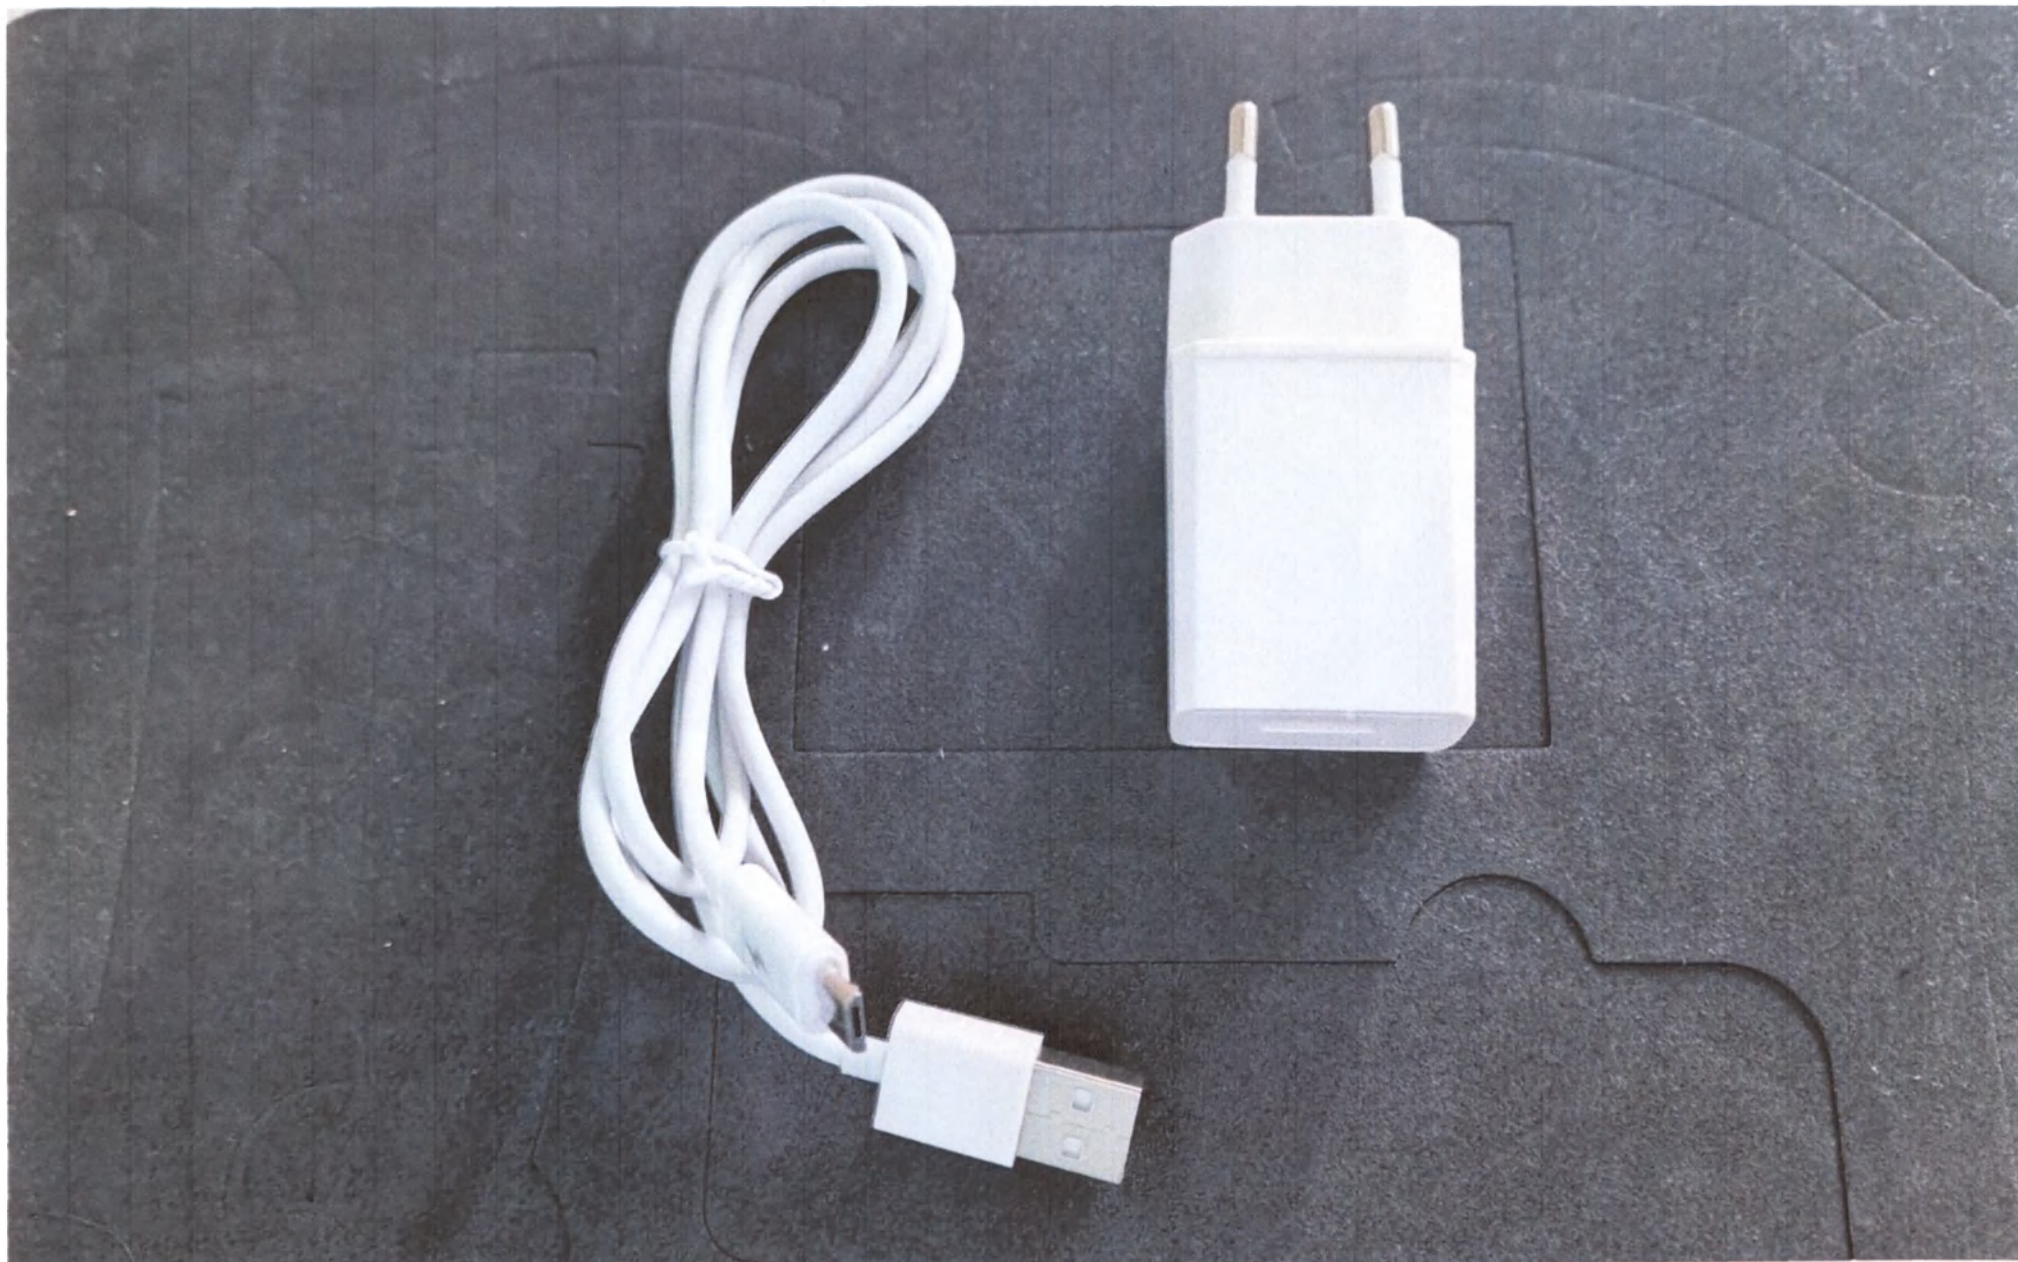


3 Видеоларингоскоп BD-VS, в составе:
3.1 Монитор 3 дюйма




3.2 Видеостилет BD-VS

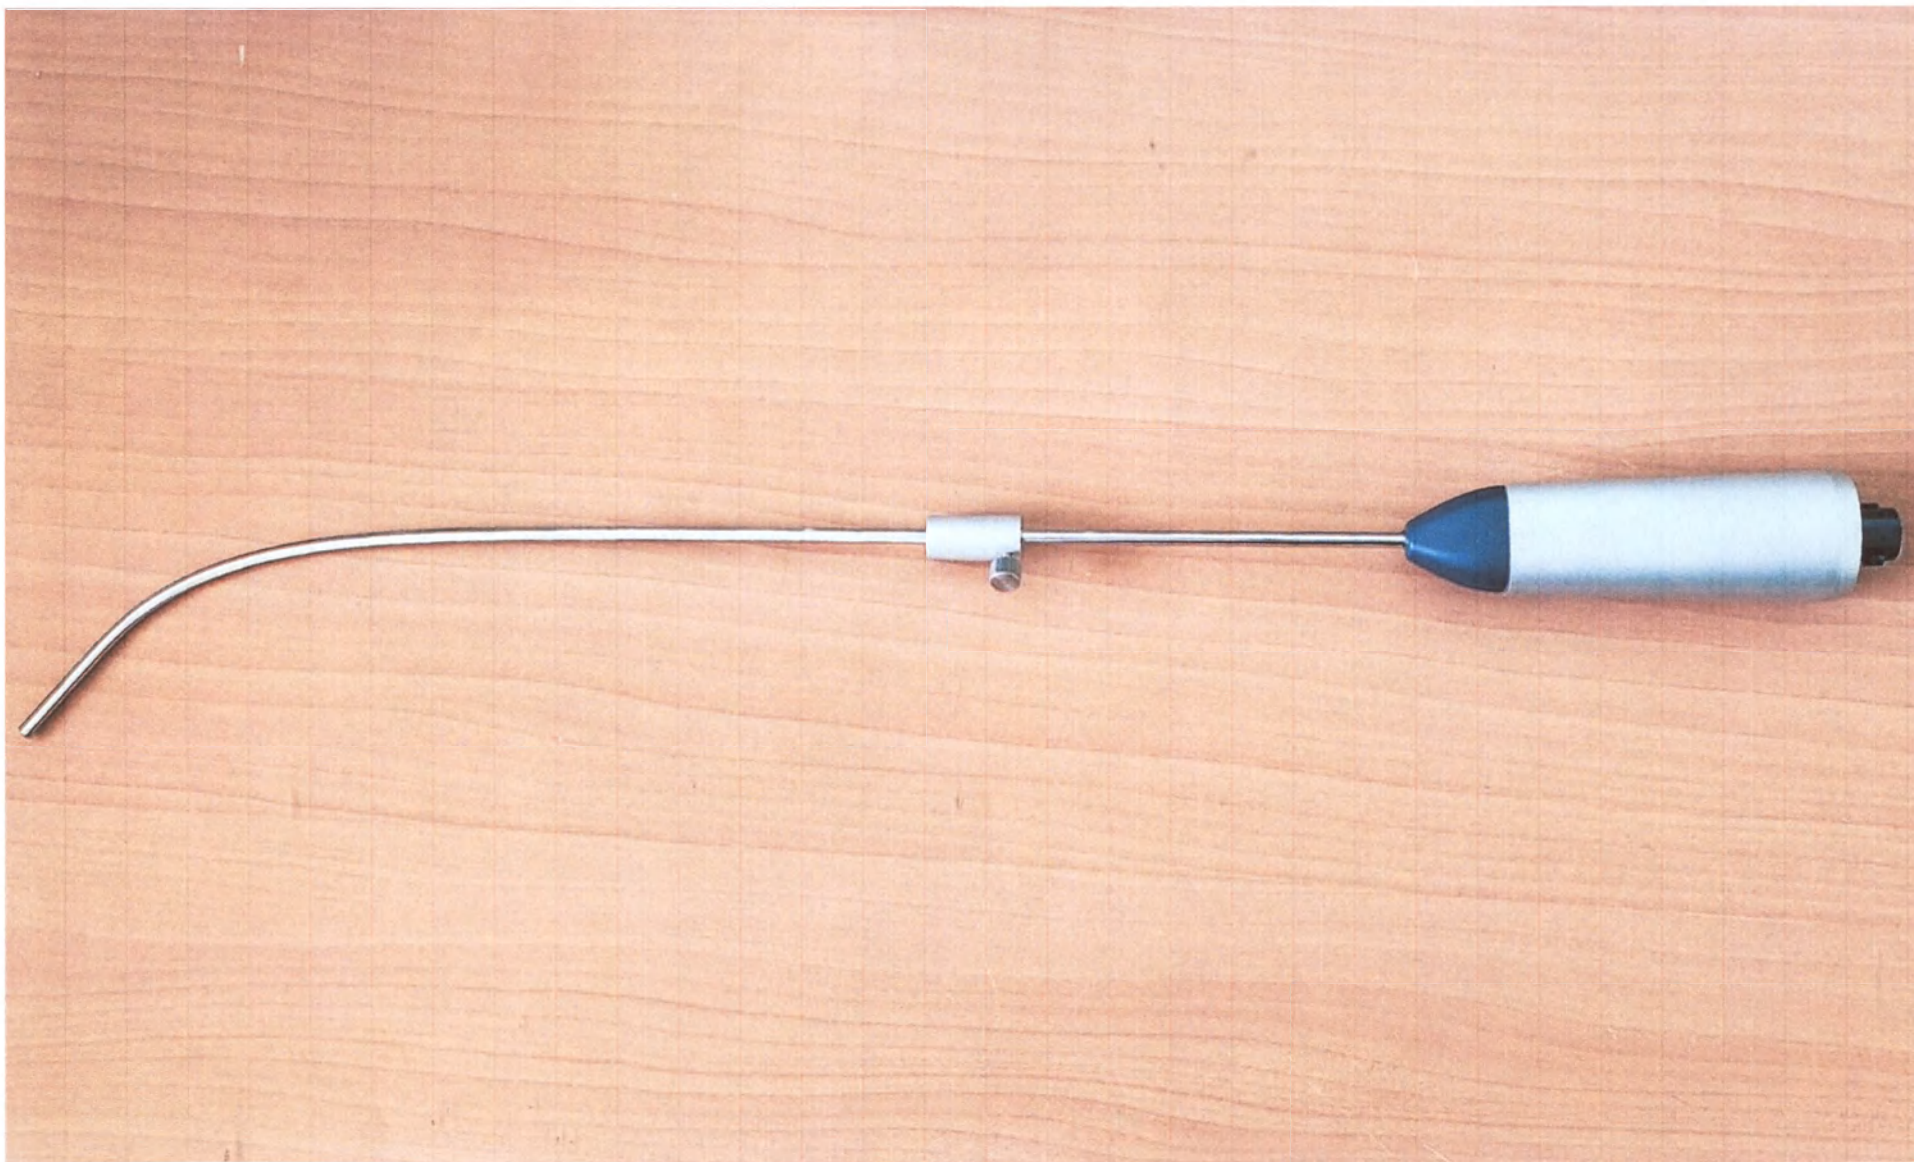

3.3 Защитный колпачок

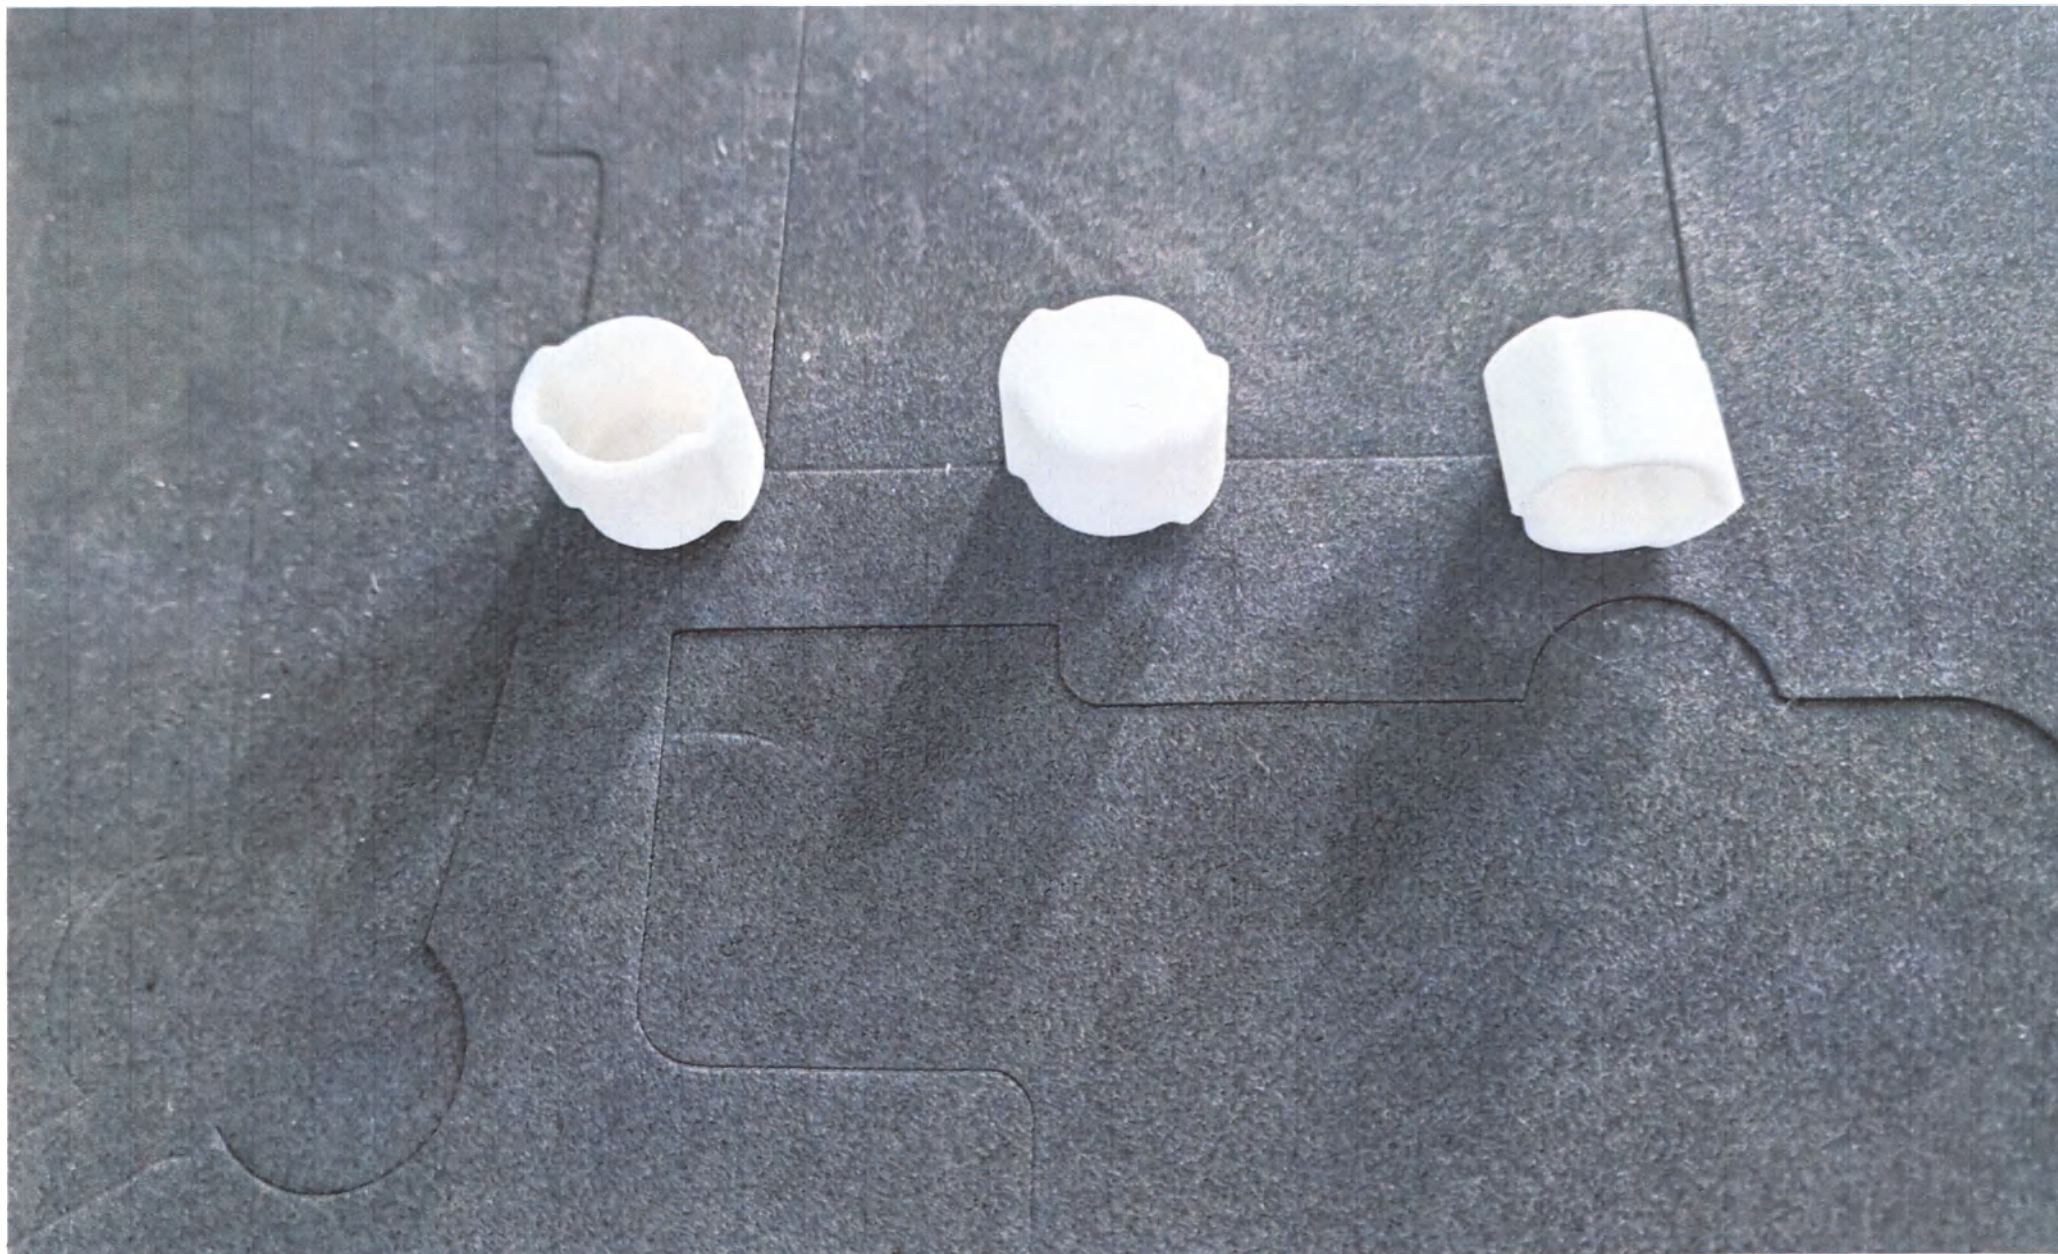

3.4 Сетевое зарядное устройство с кабелем USB

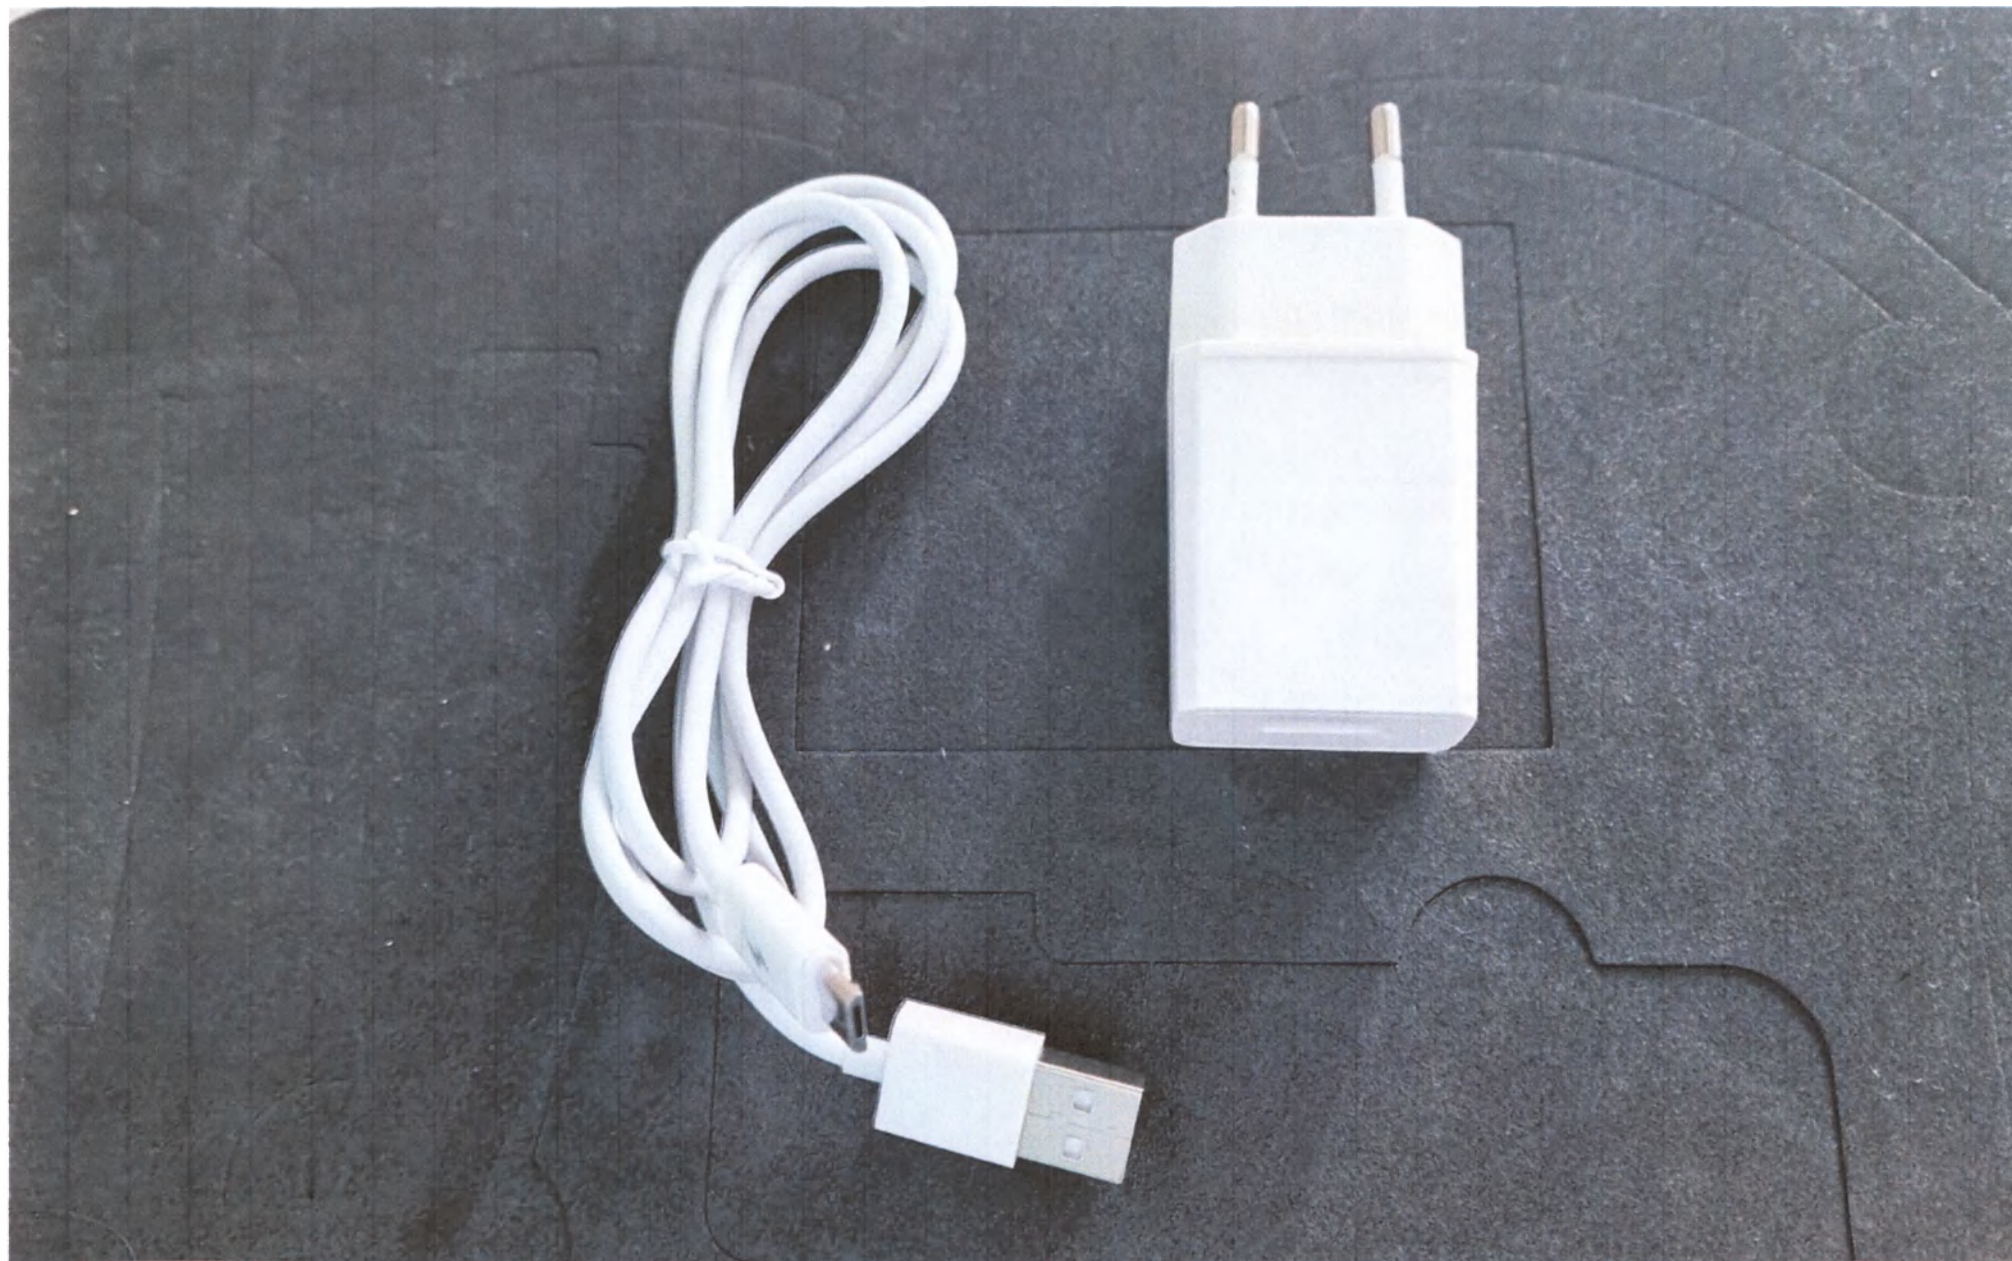

Маркировка медицинского изделия на примере видеоларингоскопа BD-DF



Маркировка потребительской упаковки на примере видеоларингоскопа BD-DF



Макет русскоязычной маркировки медицинского изделия

«Система для видеоларингоскопии»	
РУ №	от
Видеоларингоскоп BD-DF, в составе: - Монитор 3 дюйма – 1 шт.; - Клинок видеоларингоскопа, тип Миллер (Miller), размер 0 (MIL0) – X шт. - Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 1 (MAC1) – X шт. - Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 2 (MAC2) – X шт. - Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 3 (MAC3) – X шт. - Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), размер 4 (MAC4) – X шт. - Клинок видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh), для трудных дыхательных путей, D-BLADE – X шт. - Защитный колпачок – X шт. - Сетевое зарядное устройство с кабелем USB – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.	
SN:*	
     	
Источник питания:	Литий-ионный аккумулятор DC 3,7 В; емкость 1350 мА·ч
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАН" (ООО "РЕАН"), 142784, Россия, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, этаж 7, блок "Г" Тел.: +7 495-374-77-56; e-mail: info@reanmed.ru	
	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Бесдэйта Технолоджи Ко., Лтд.) 503, Building #2, Xinnantian Industrial Park, No. 3179, Danzi Avenue, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China / Китай
Сделано в Китае	

Макет русскоязычной маркировки видеоларингоскопа BD-DF

«Система для видеоларингоскопии»	
РУ №	от
Видеоларингоскоп BD-DP, в составе: - Монитор 3 дюйма – 1 шт.; - Рукоятка видеоларингоскопа, тип Макинтош (Macintosh) – X шт.; - Рукоятка видеоларингоскопа, тип Миллер (Miller) – X шт.; - Сетевое зарядное устройство с кабелем USB – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.	
SN:*	
     	
Источник питания:	Литий-ионный аккумулятор DC 3,7 В; емкость 1350 мА·ч
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАН" (ООО "РЕАН"), 142784, Россия, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, этаж 7, блок "Г" Тел.: +7 495-374-77-56; e-mail: info@reanmed.ru	
	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Бесдэйта Технолоджи Ко., Лтд.) 503, Building #2, Xinnantian Industrial Park, No. 3179, Danzi Avenue, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China / Китай
Сделано в Китае	

Макет русскоязычной маркировки видеоларингоскопа BD-DP

«Система для видеоларингоскопии»	
РУ №	от
Видеоларингоскоп BD-VS, в составе: - Монитор 3 дюйма – 1 шт.; - Видеостилет BD-VS – X шт. - Защитный колпачок – X шт. - Сетевое зарядное устройство с кабелем USB – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.	
SN:*	
     	
Источник питания:	Литий-ионный аккумулятор DC 3,7 В; емкость 1350 мА·ч
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАН" (ООО "РЕАН"), 142784, Россия, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, этаж 7, блок "Г" Тел.: +7 495-374-77-56; e-mail: info@reanmed.ru	
	Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Бесдэйта Технолоджи Ко., Лтд.) 503, Building #2, Xinnantian Industrial Park, No. 3179, Danzi Avenue, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China / Китай
Сделано в Китае	

Макет русскоязычной маркировки видеоларингоскопа BD-VS

* – серийные номера составных компонентов системы для видеоларингоскопии

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

(23) листов

