


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела качества и нормативного
регулирования ООО "Био-Рад Лаборатории"

Иванникова Ю.И.

«15» марта 2024 г.


По доверенности № 19/2024
от 01.12.2023**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ****«Система автоматическая для определения гликированного
гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin
Testing System) для in vitro диагностики, в составе, варианты
исполнения»****производства «Bio-Rad Laboratories, Inc.» («Био-Рад Лабораториз,
Инк.»), США**

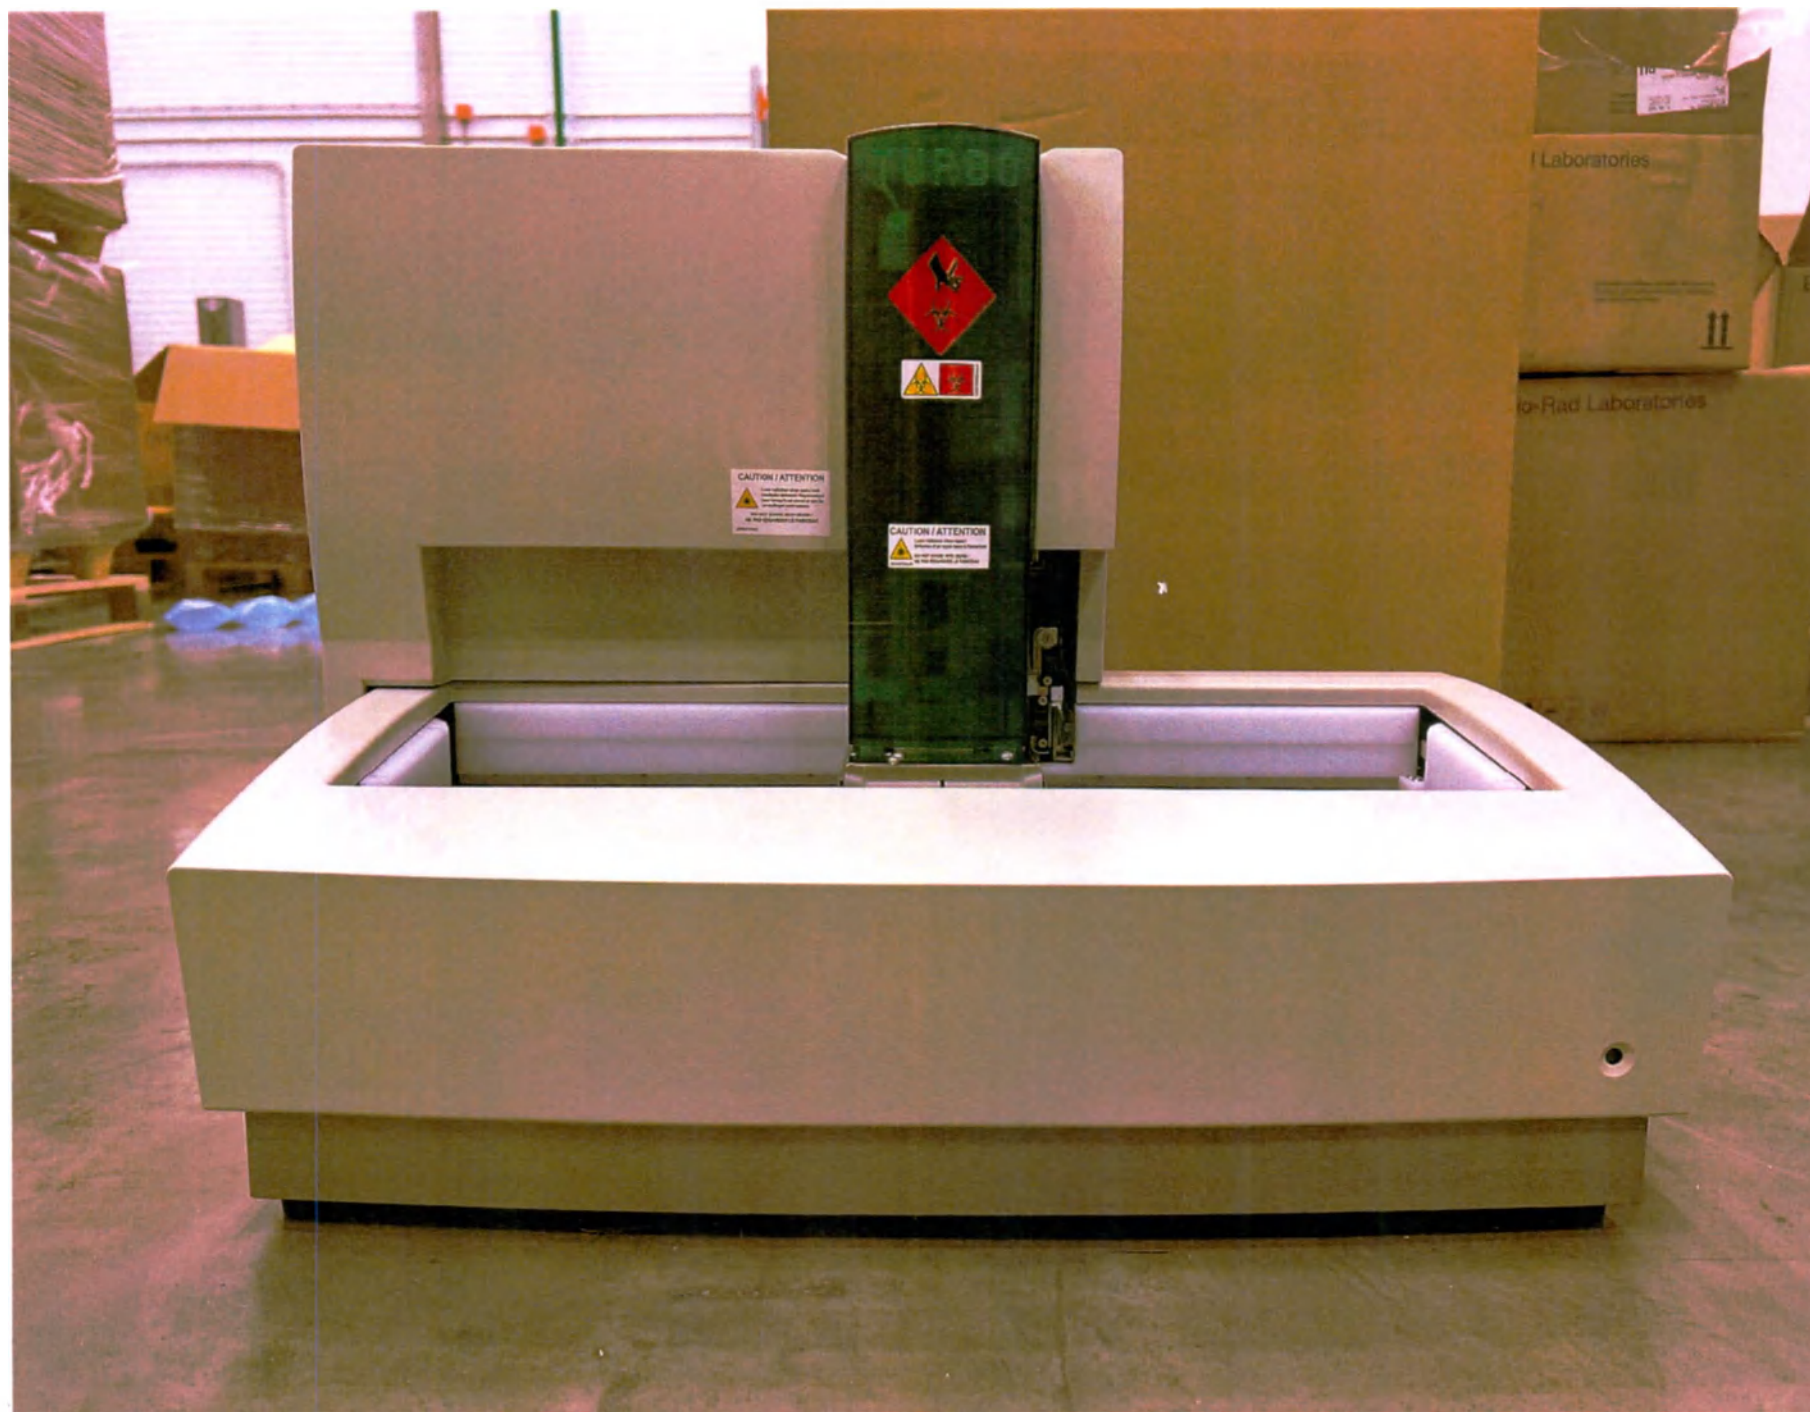







**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Хроматографическая станция (VCS) – 1 шт.»**

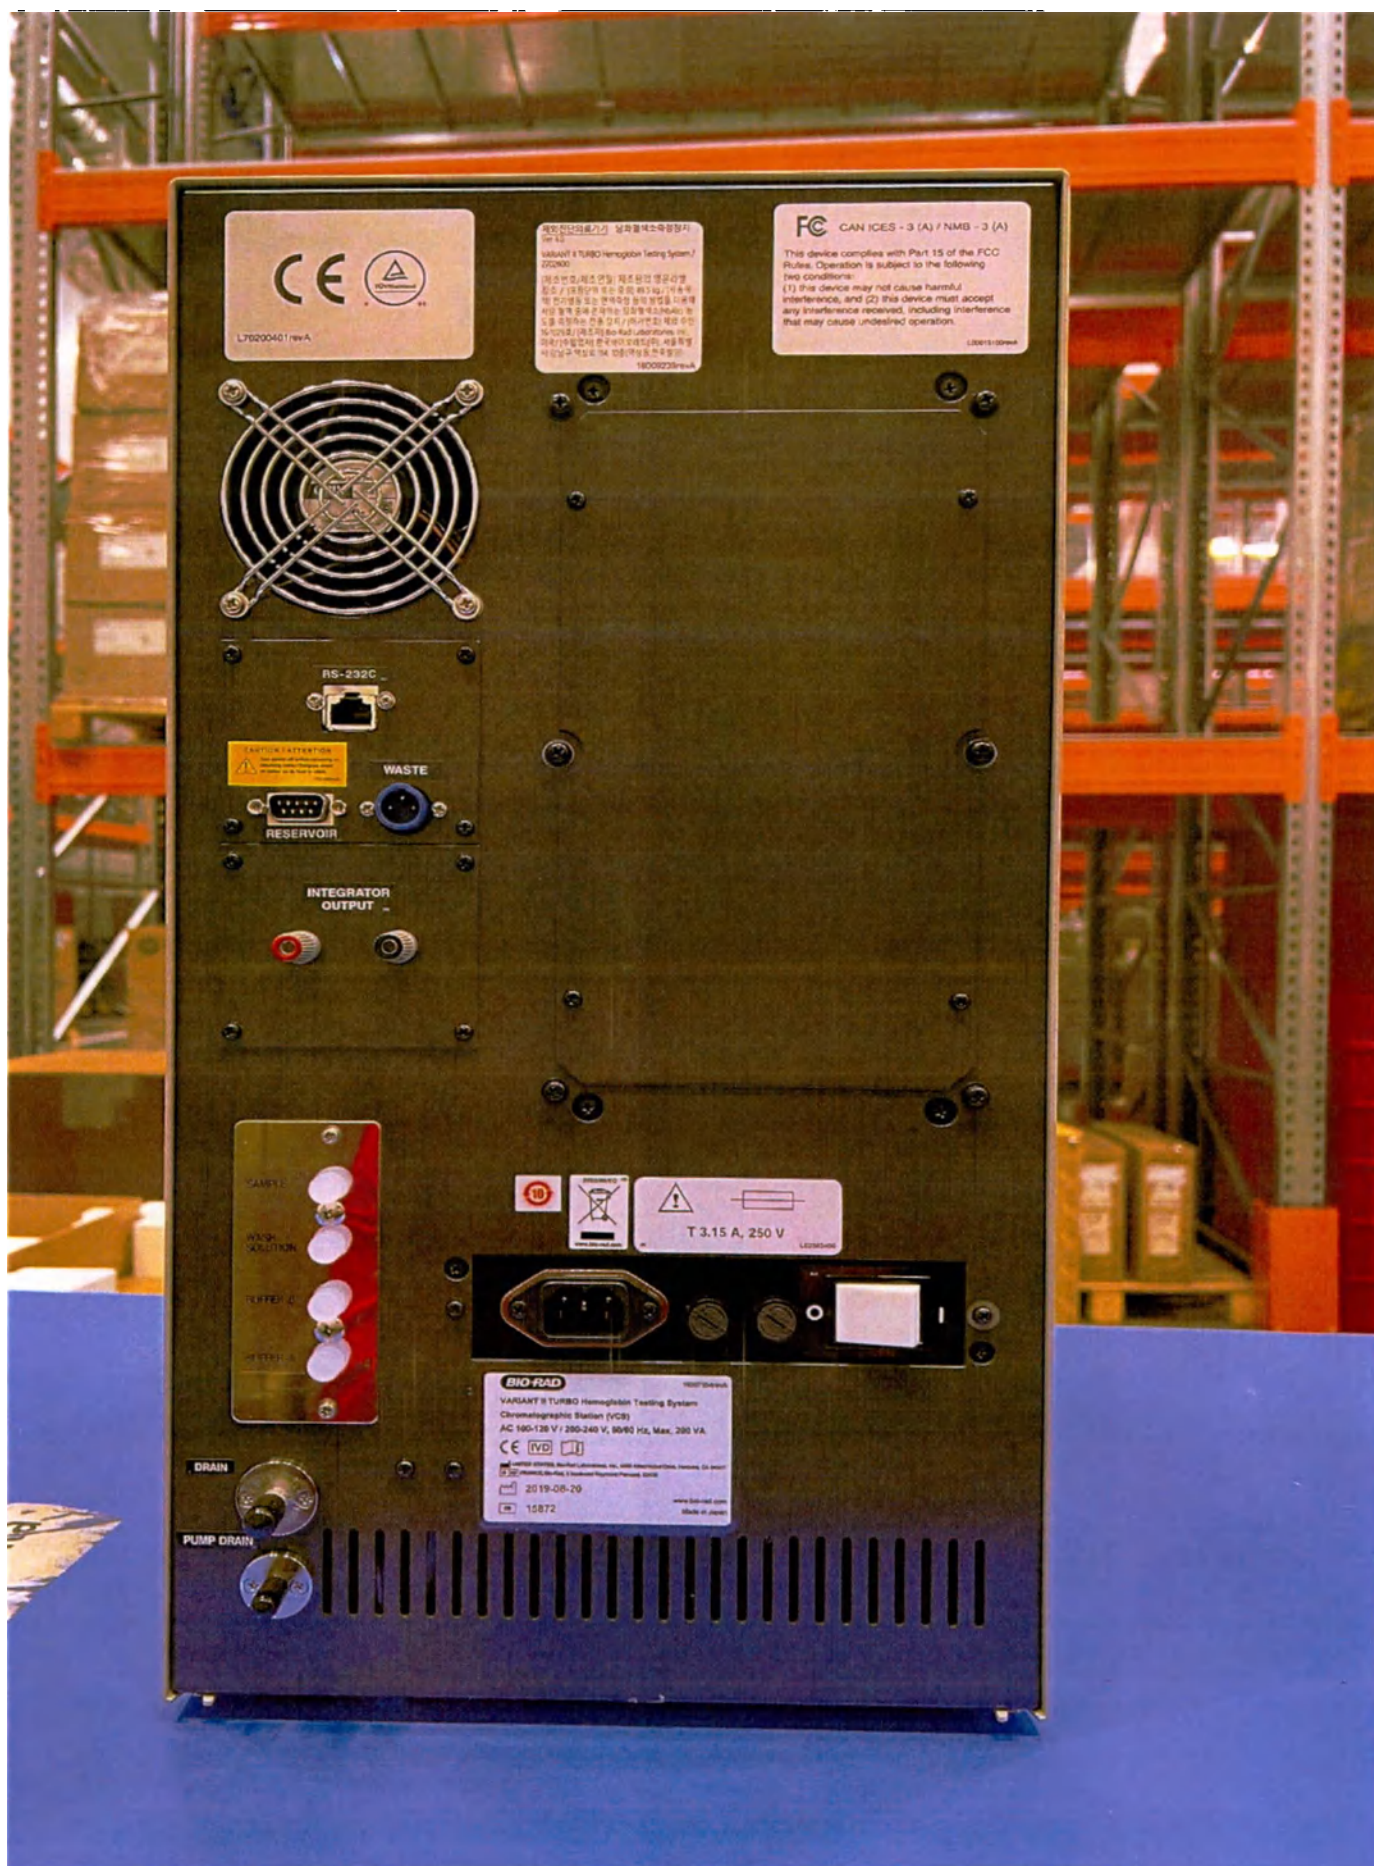


Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Хроматографическая станция (VCS) – 1 шт.»

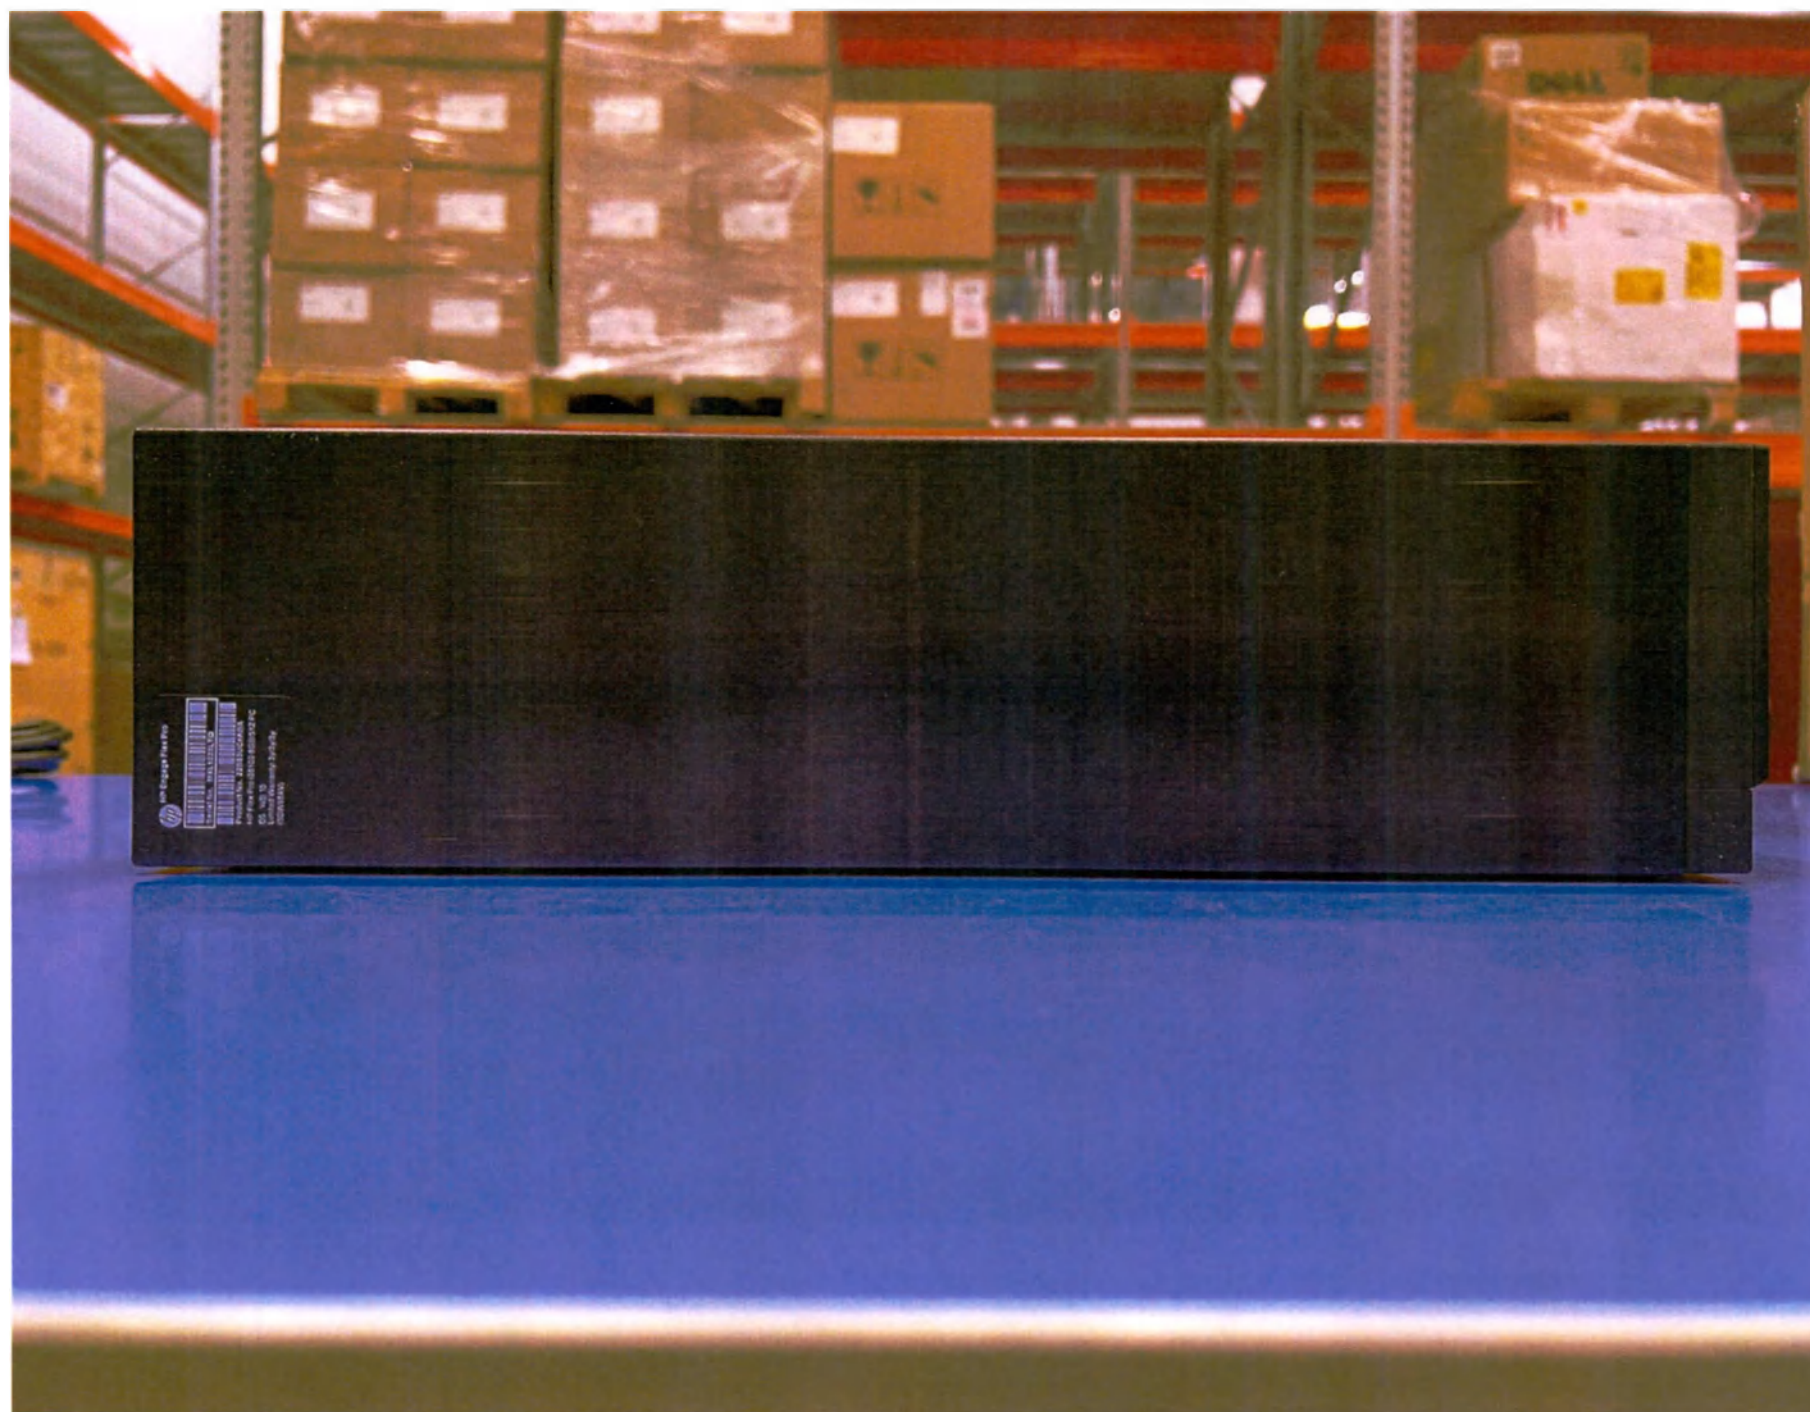

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Системный блок – 1 шт., в комплектации»
*(применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II
 TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)*

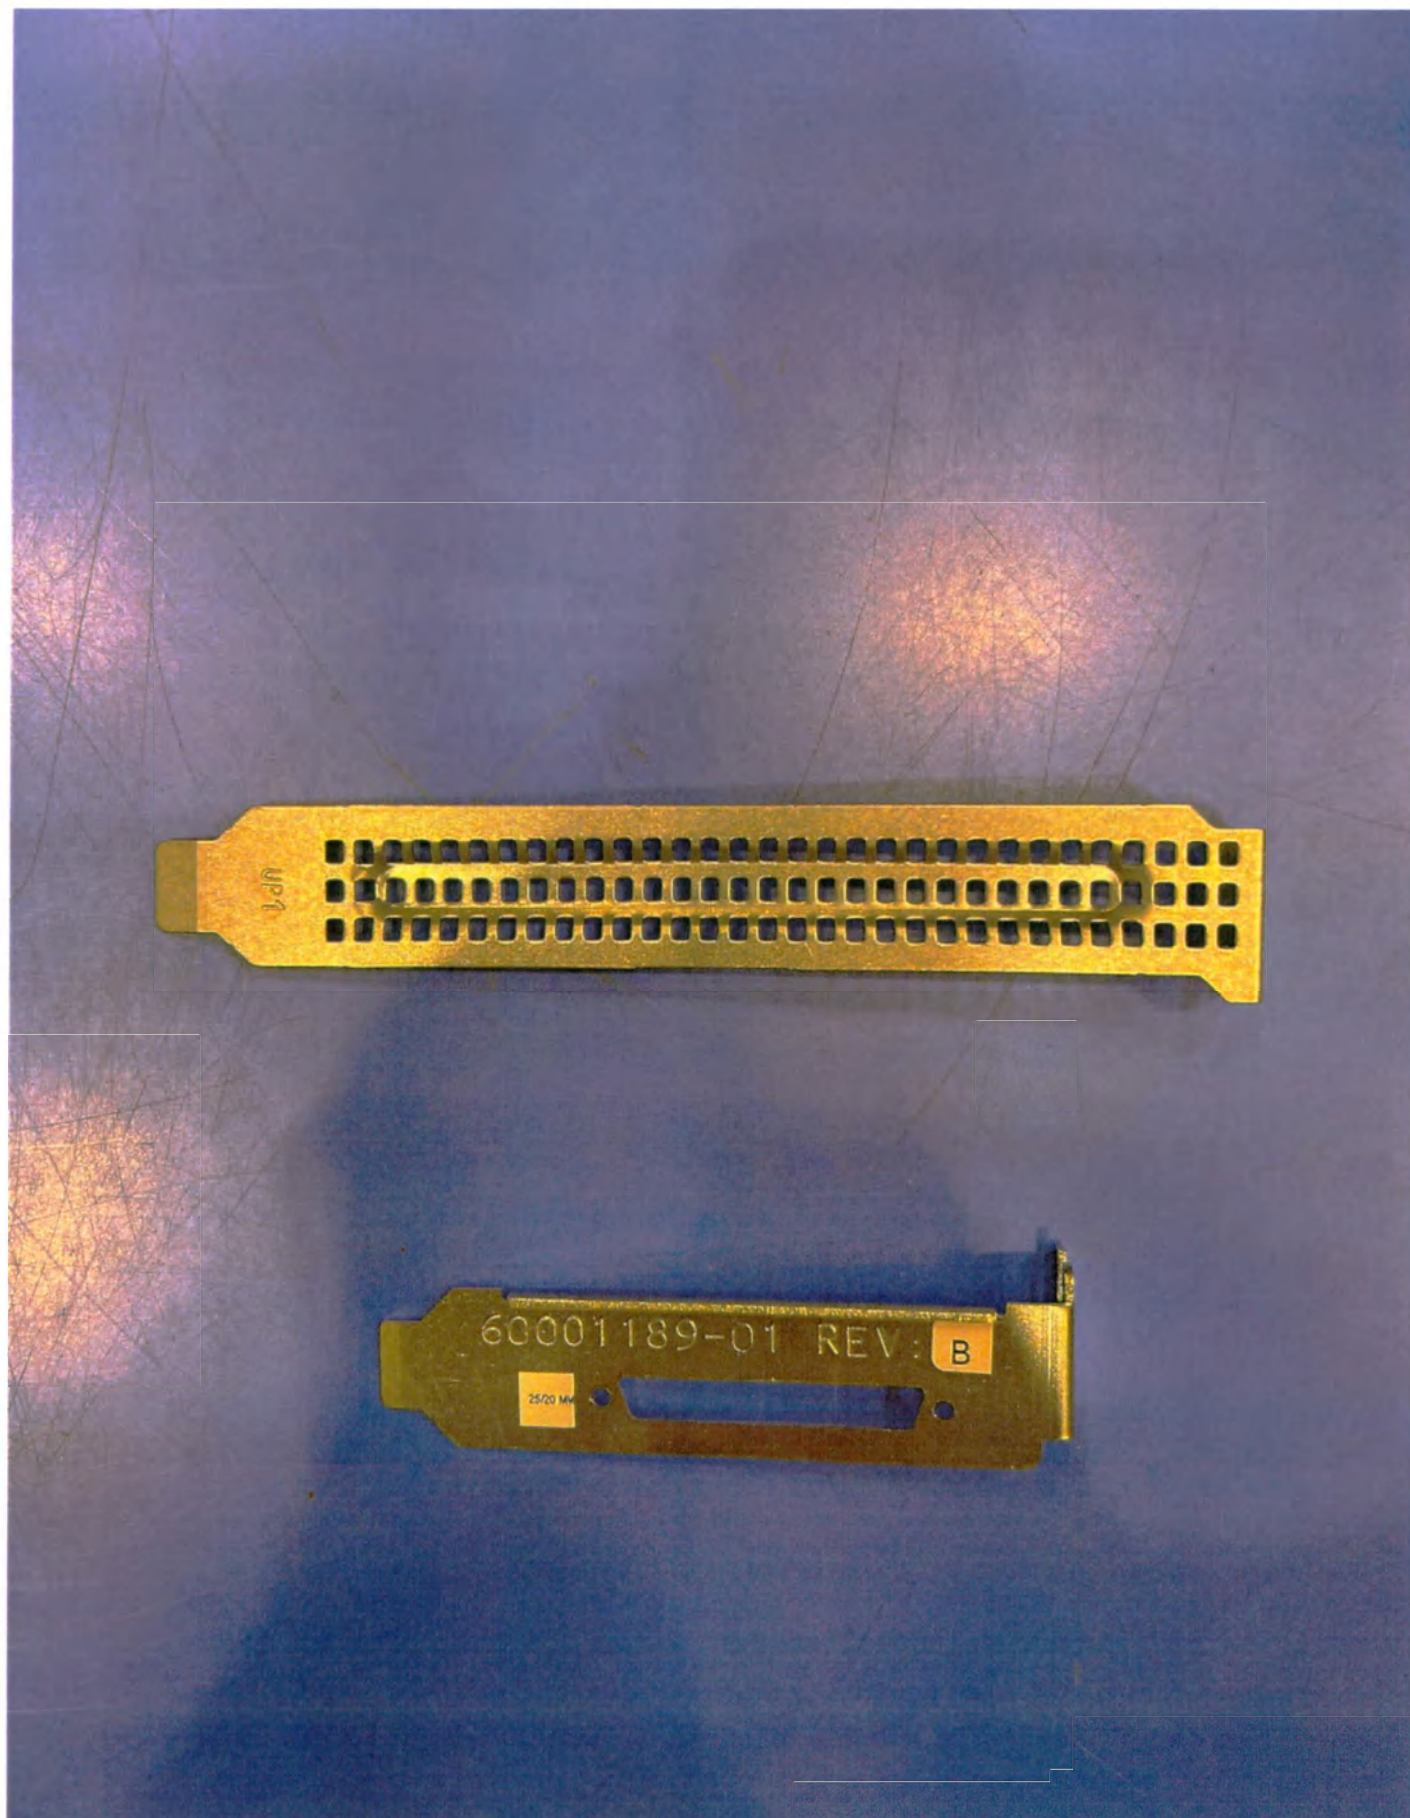

Компонент системного блока: «Металлическая заглушка – не более 2 шт. (при необходимости)»
(применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина *VARIANT II TURBO* (*VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System*) с компьютером, в составе»)

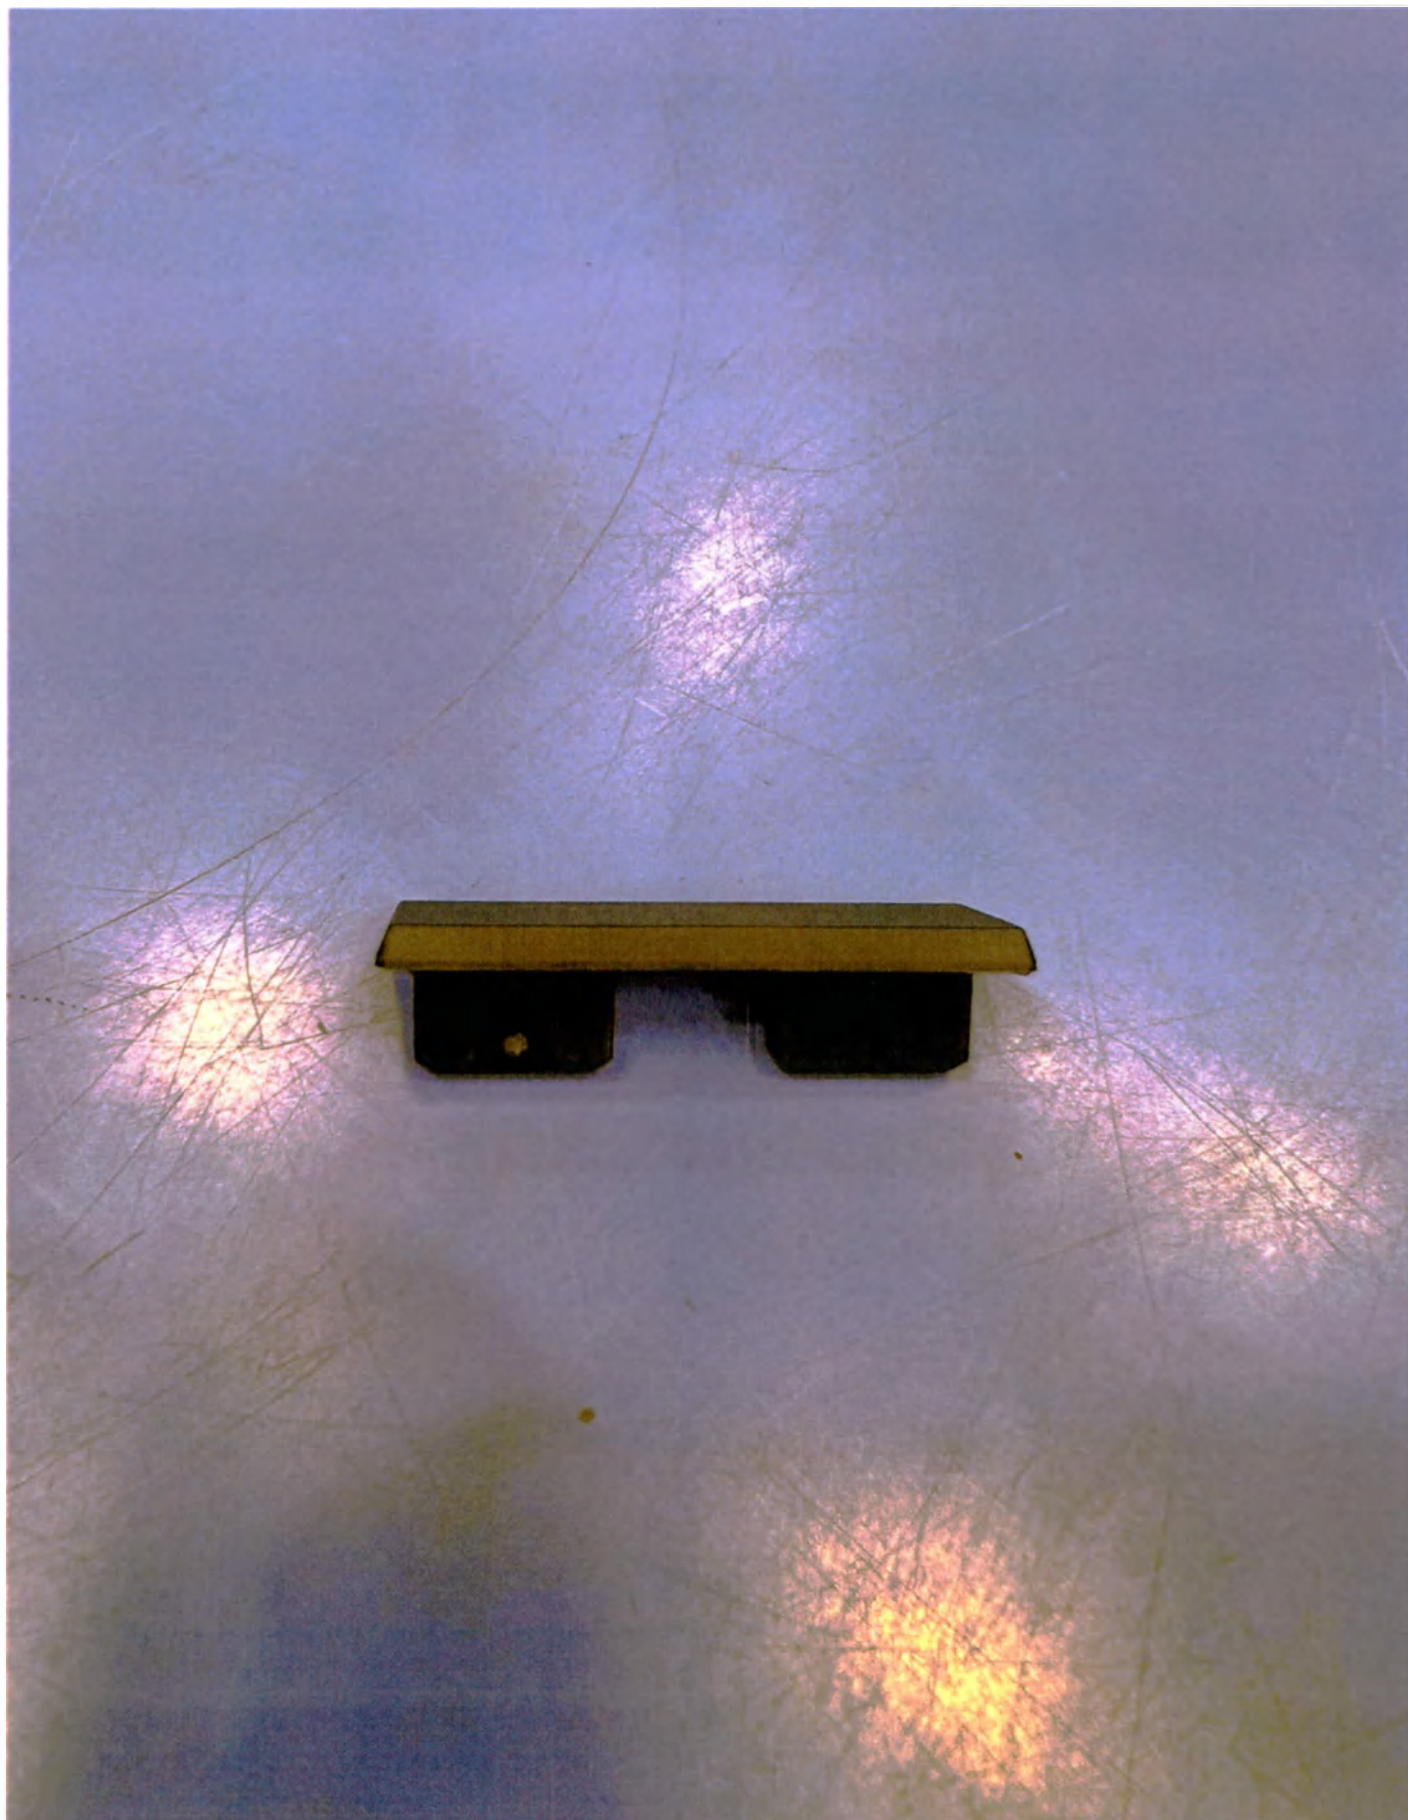

Компонент системного блока: «Заглушка для USB порта – 1 шт. (при необходимости)»
(применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина *VARIANT II TURBO* (*VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System*) с компьютером, в составе»)



Компонент системного блока: «Заглушка для DVI порта – 1 шт. (при необходимости)»
(применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения
гликированного гемоглобина *VARIANT II TURBO* (*VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System*)
с компьютером, в составе»)



Компонент системного блока: «Шнур с разъемами – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)



Компонент системного блока: «Кабель питания – 1 шт. (при необходимости)»


(применяемо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)




Компонент системного блока: «Клавиатура – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)




Компонент системного блока: «Компьютерная мышь – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)

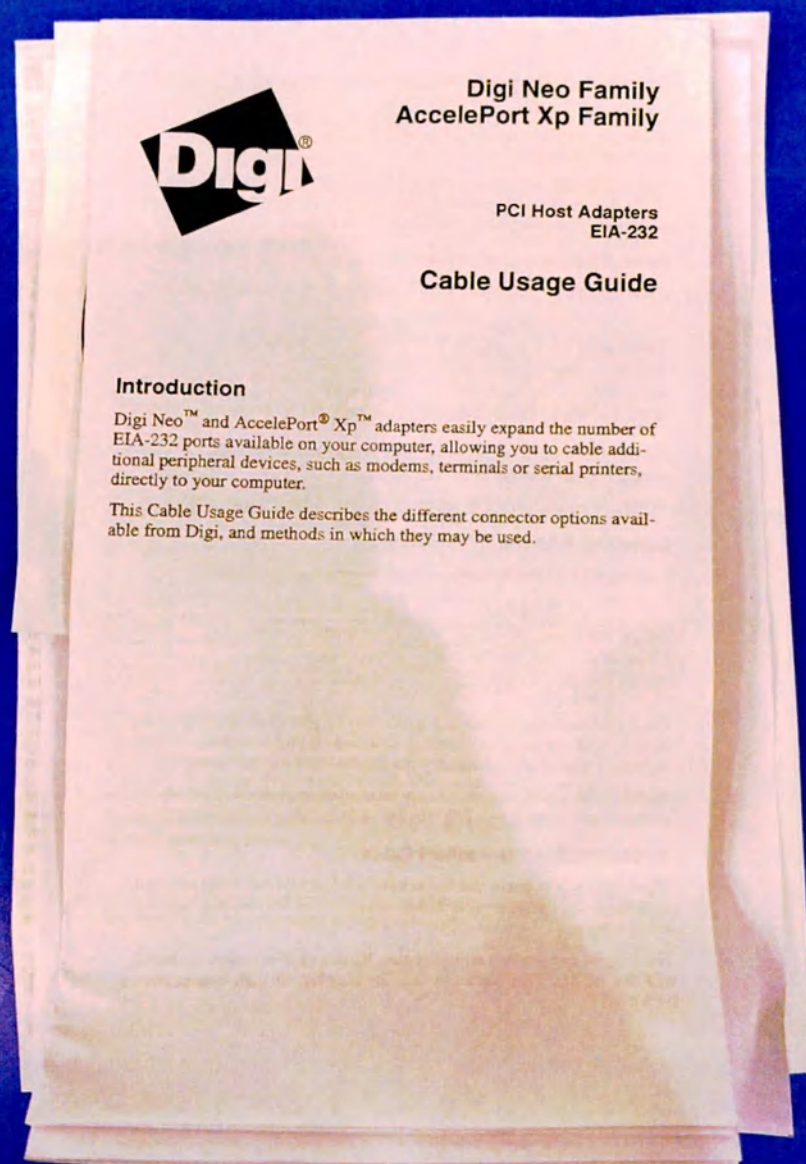


Компонент системного блока: «Комплект документации по инсталляции – 1 уп. (при необходимости)» (применяемо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)

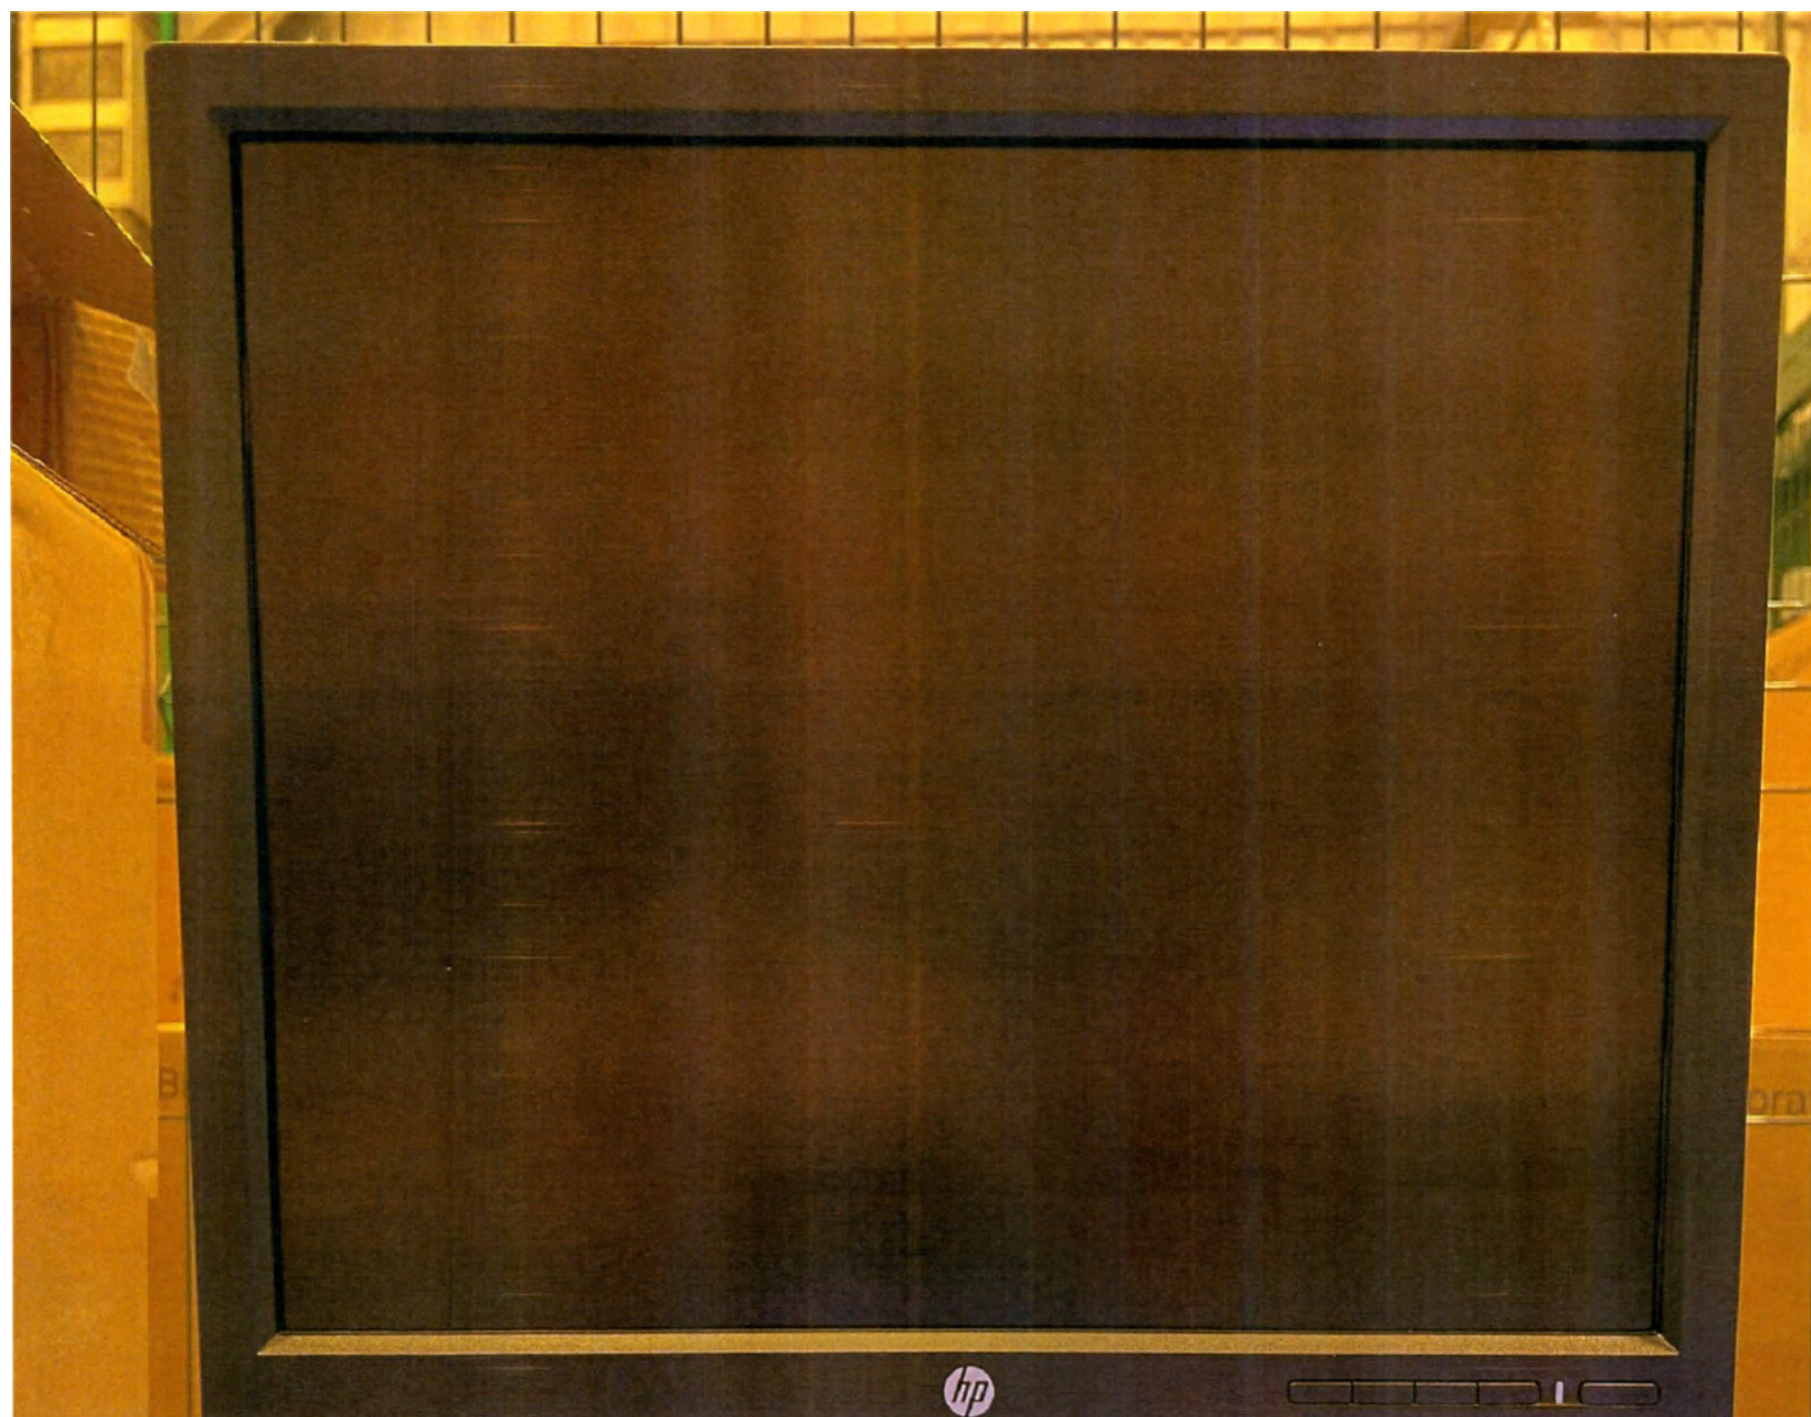

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Монитор – 1 шт., в комплектации» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)

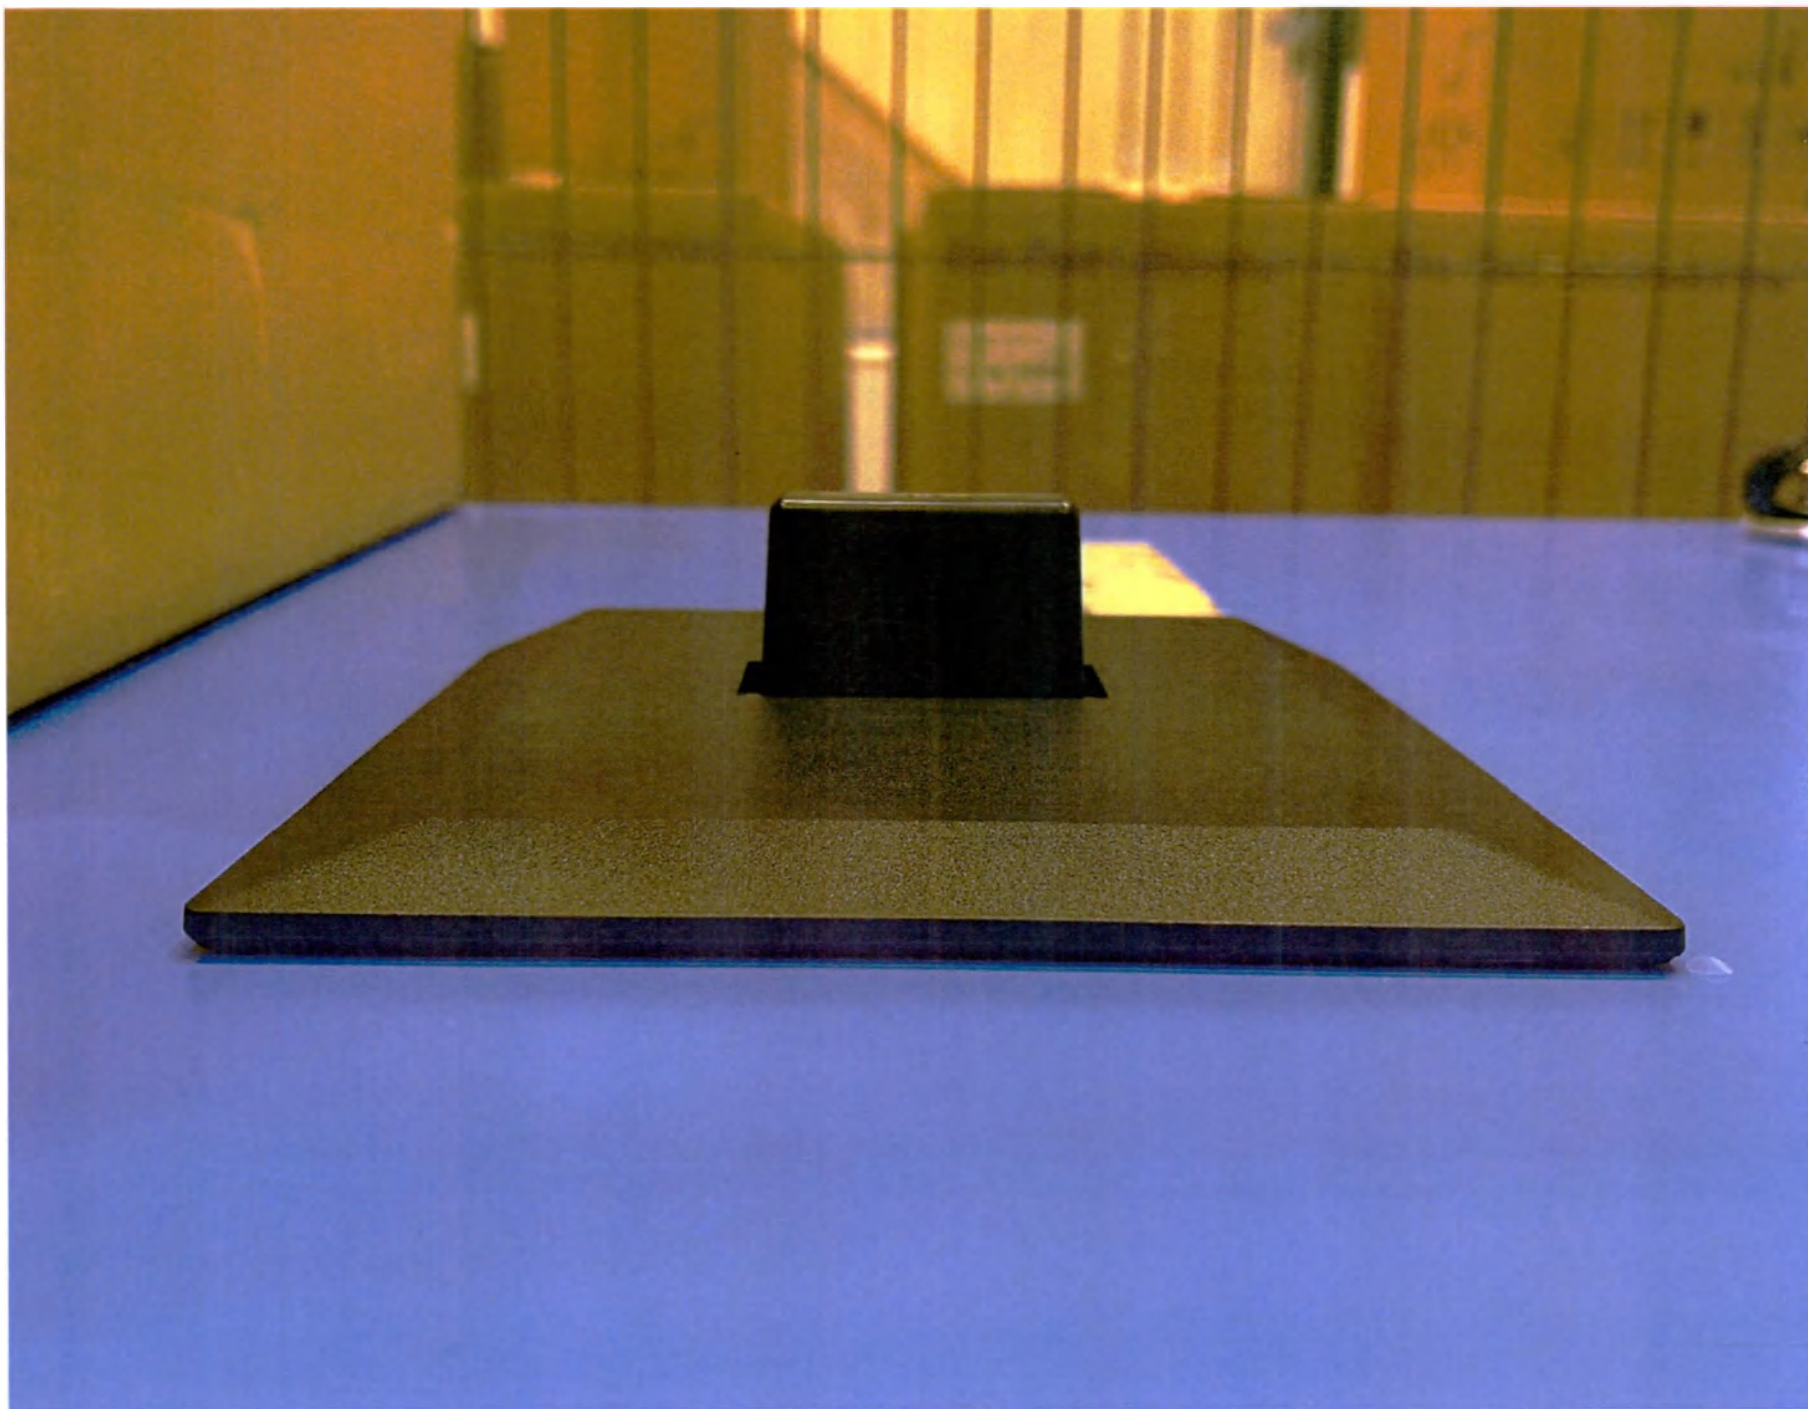

Компонент монитора: «Подставка для монитора – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)

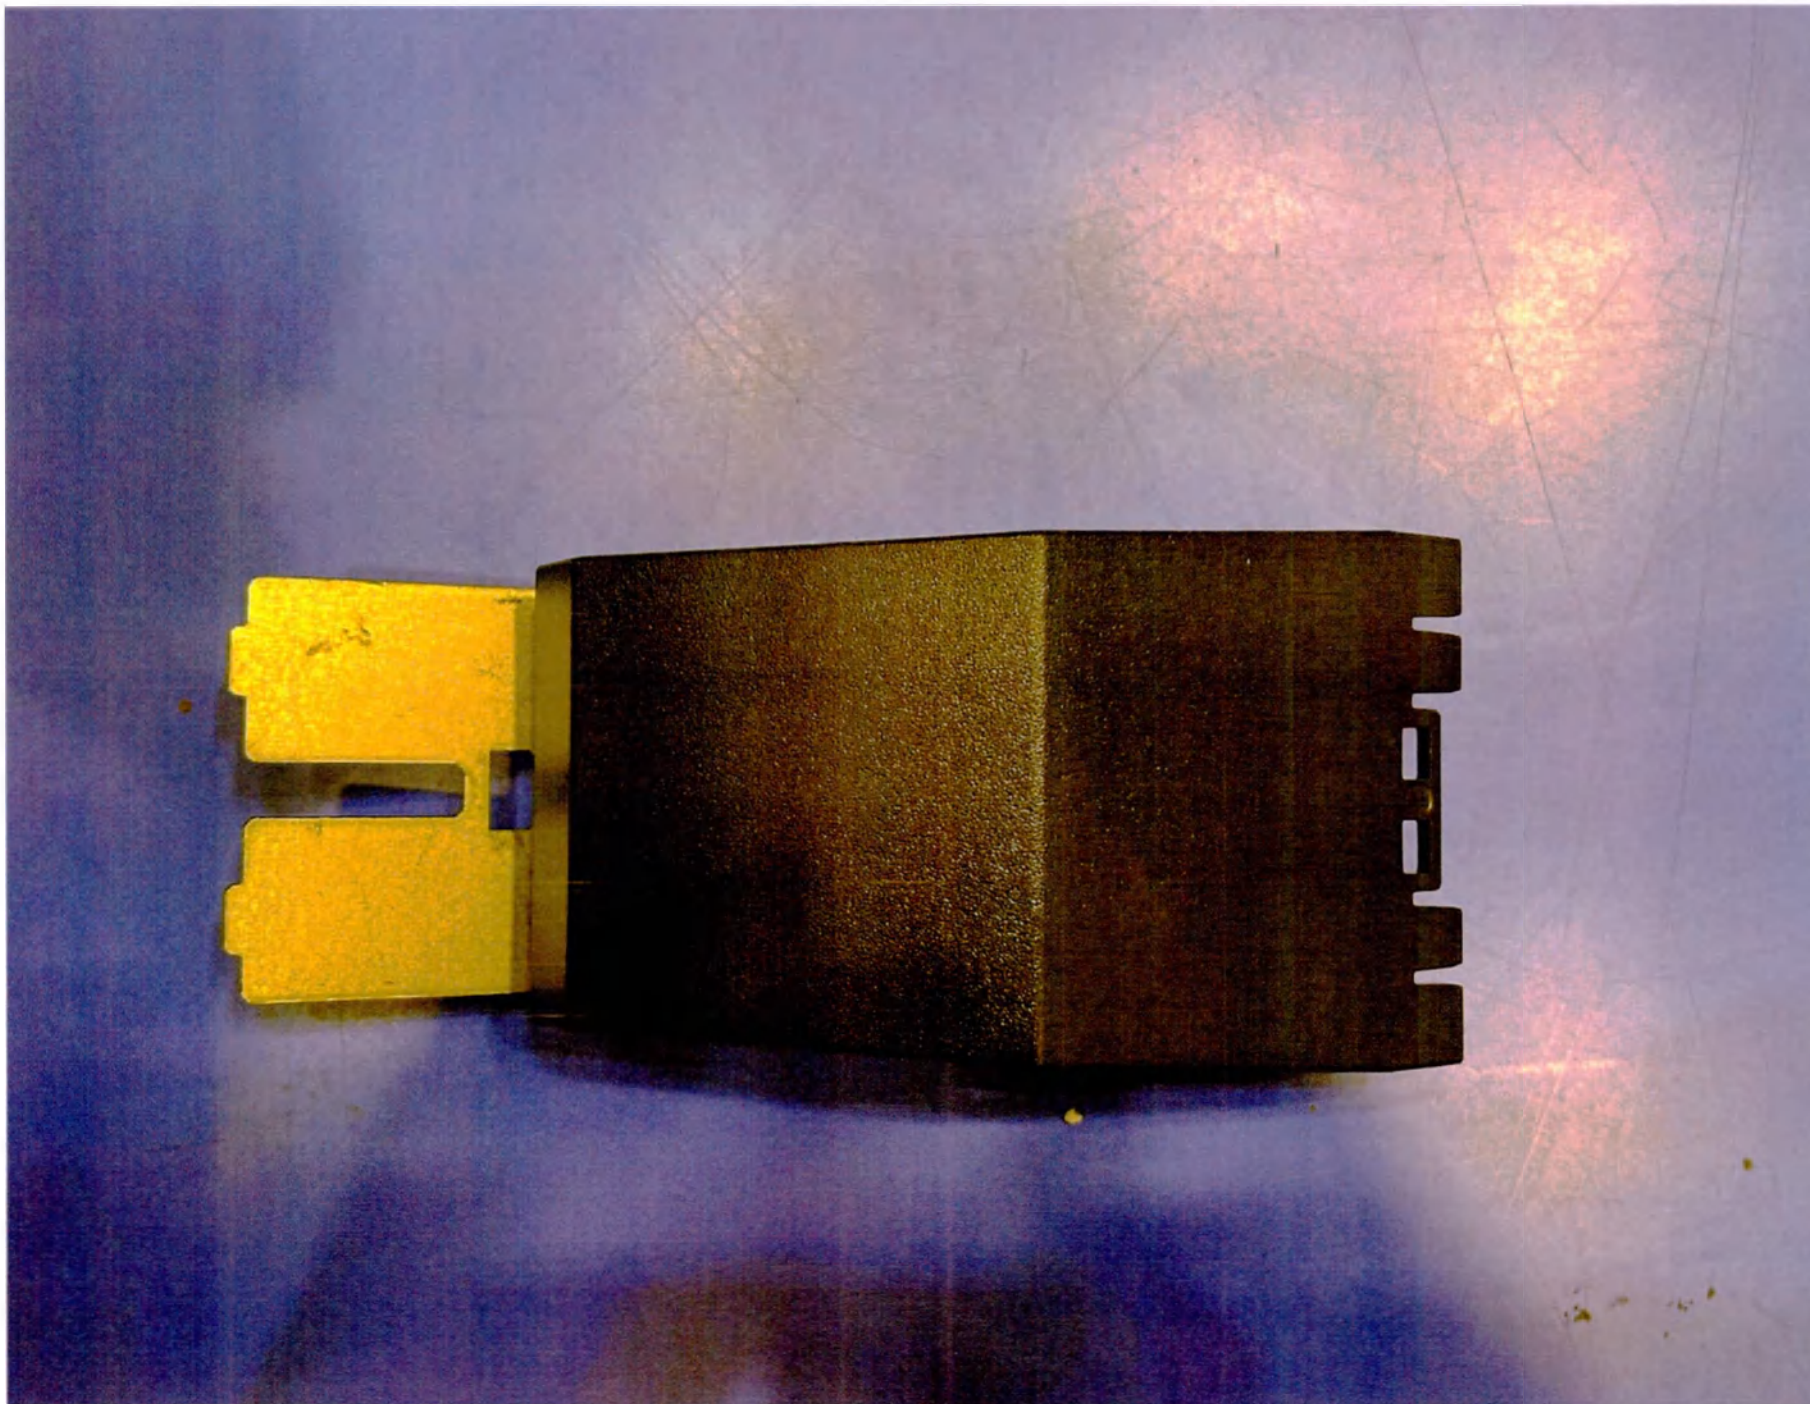


Компонент монитора: «Подставка для монитора – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)



Компонент монитора: «Кабель питания - 1 шт. (при необходимости)» *(применяю только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина (GLARIANT II TURBO) (GLARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)*



Компонент монитора: «Кабель DVI – 1 шт. (при необходимости)» (применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с компьютером, в составе»)

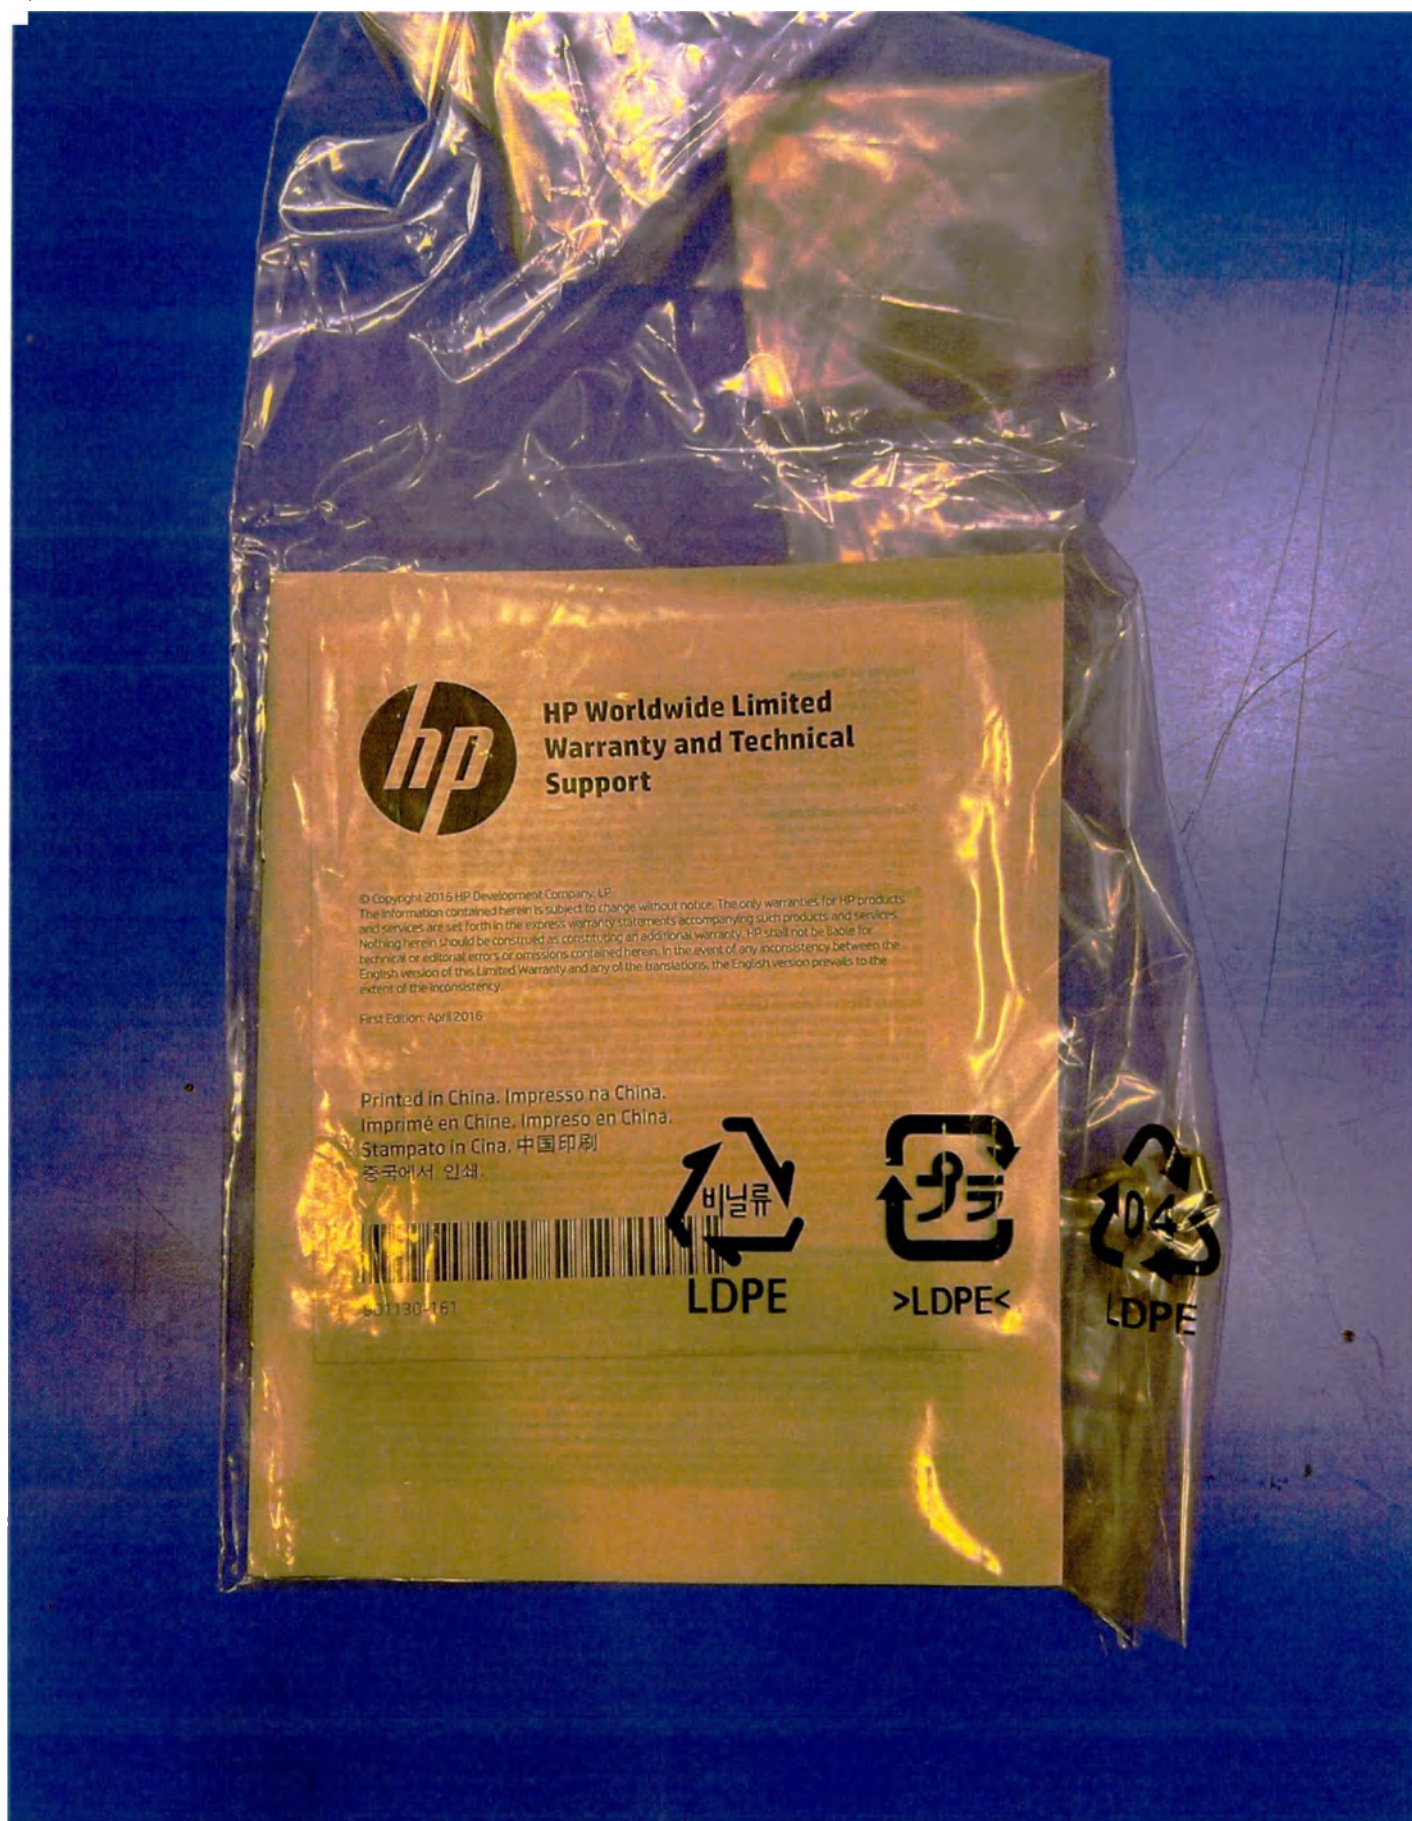

**Компонент монитора: «Комплект документации по инсталляции -- 1 уп. (при необходимости)»
(применимо только для варианта исполнения «Система автоматическая для определения
гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO (VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System) с
компьютером. в составе»)**



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Кабель питания для станции отбора образцов (VSS) – 1 шт.»



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Кабель питания для хроматографической станции (VCS) – 1 шт.»



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Контейнер для отходов – 1 шт.»




Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Резервуар для реагентов – 1 шт.»



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Кабель RS-232 – 1 шт.»




Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Кабель датчика уровня отходов – 1 шт.»

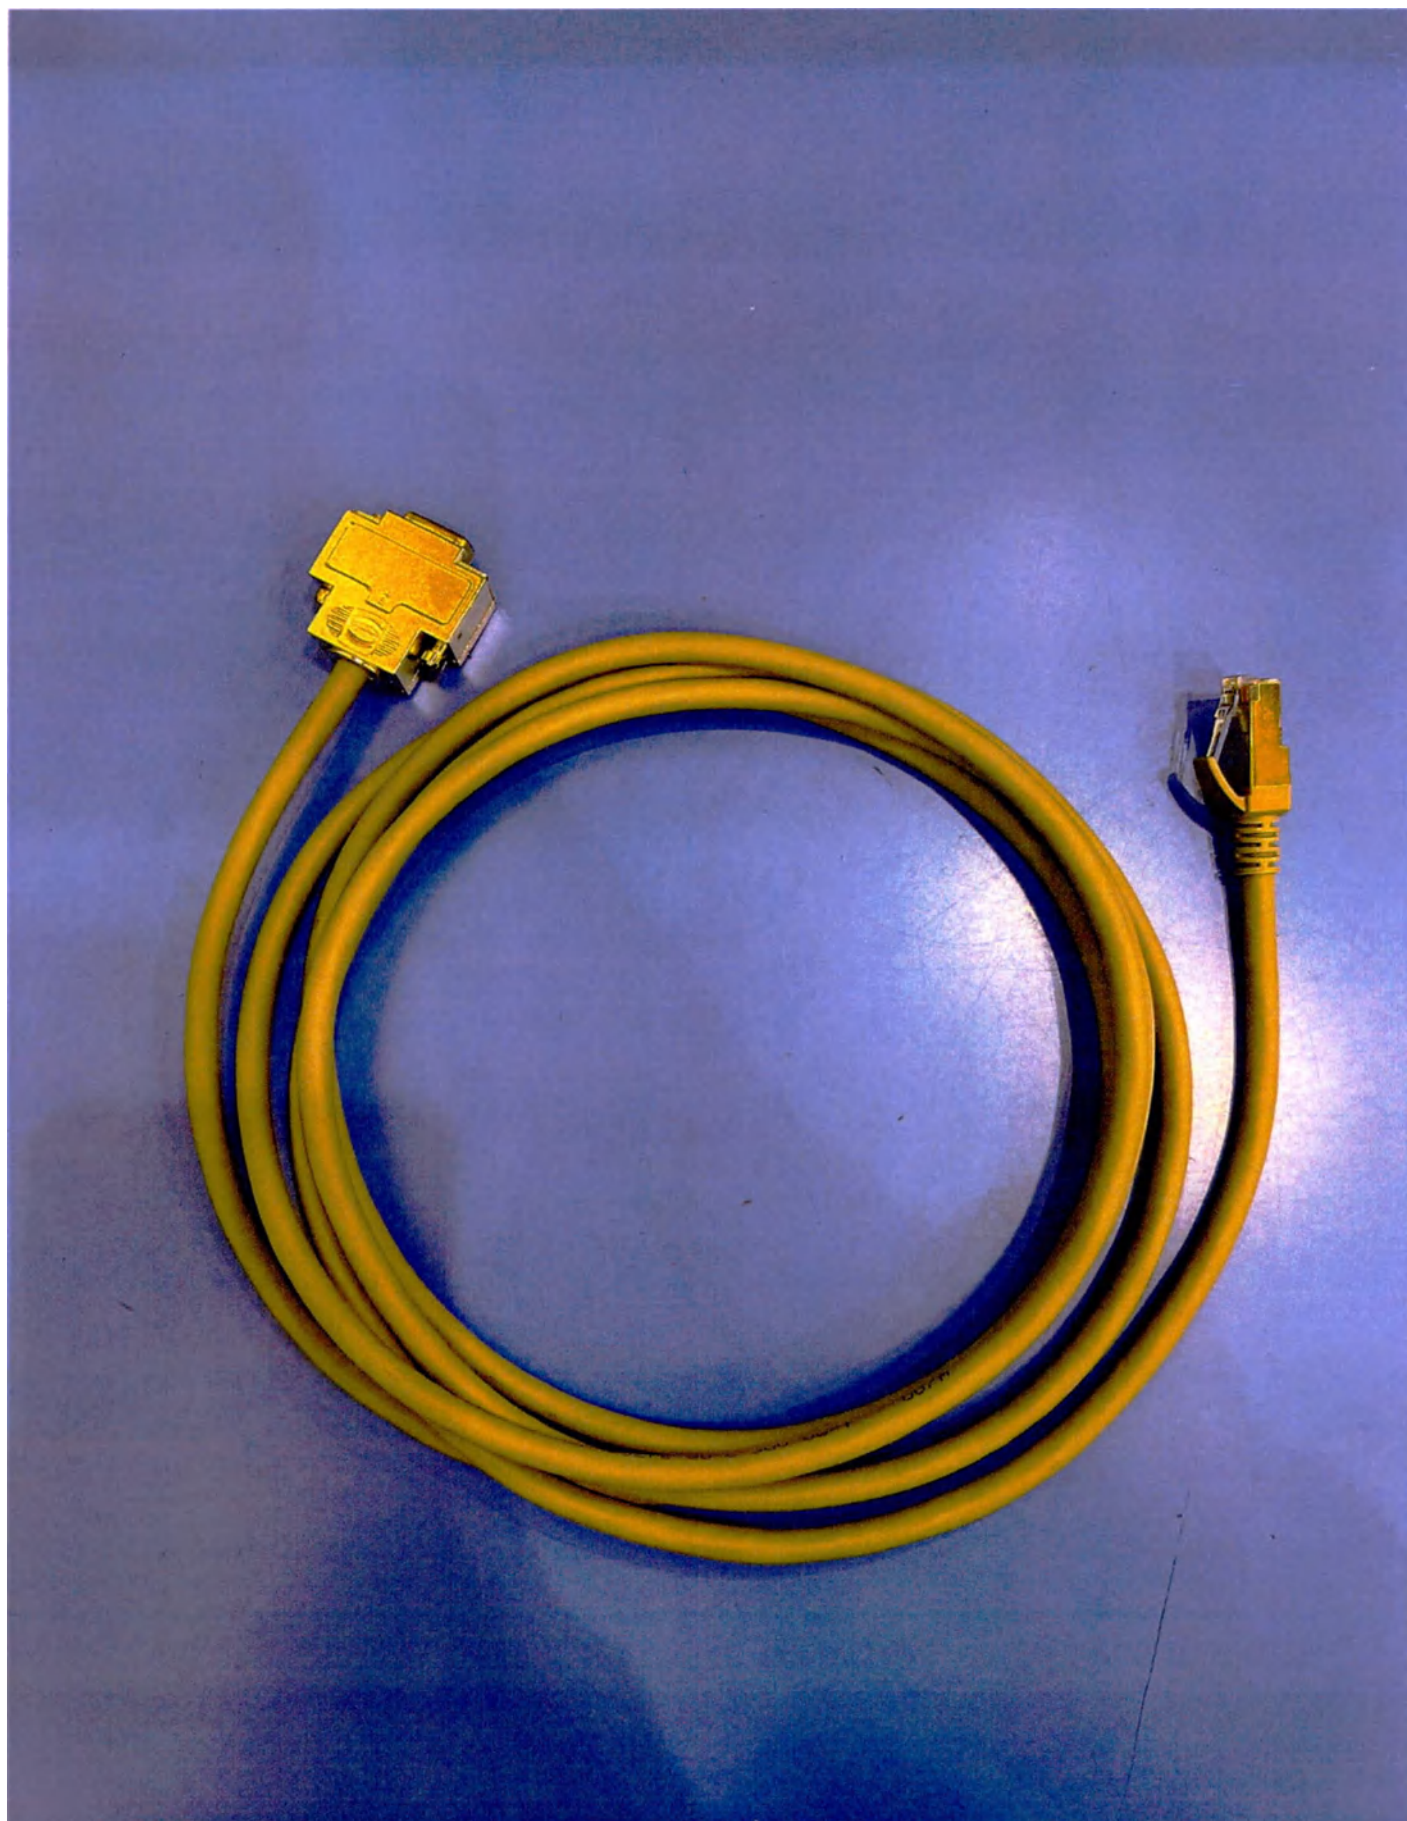

**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Коммуникационный кабель RJ-45 – не более 2 шт. (при необходимости)»**




Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Трубка для контейнера для отходов для станции отбора образцов (VSS) – 1 шт. (при
необходимости)»

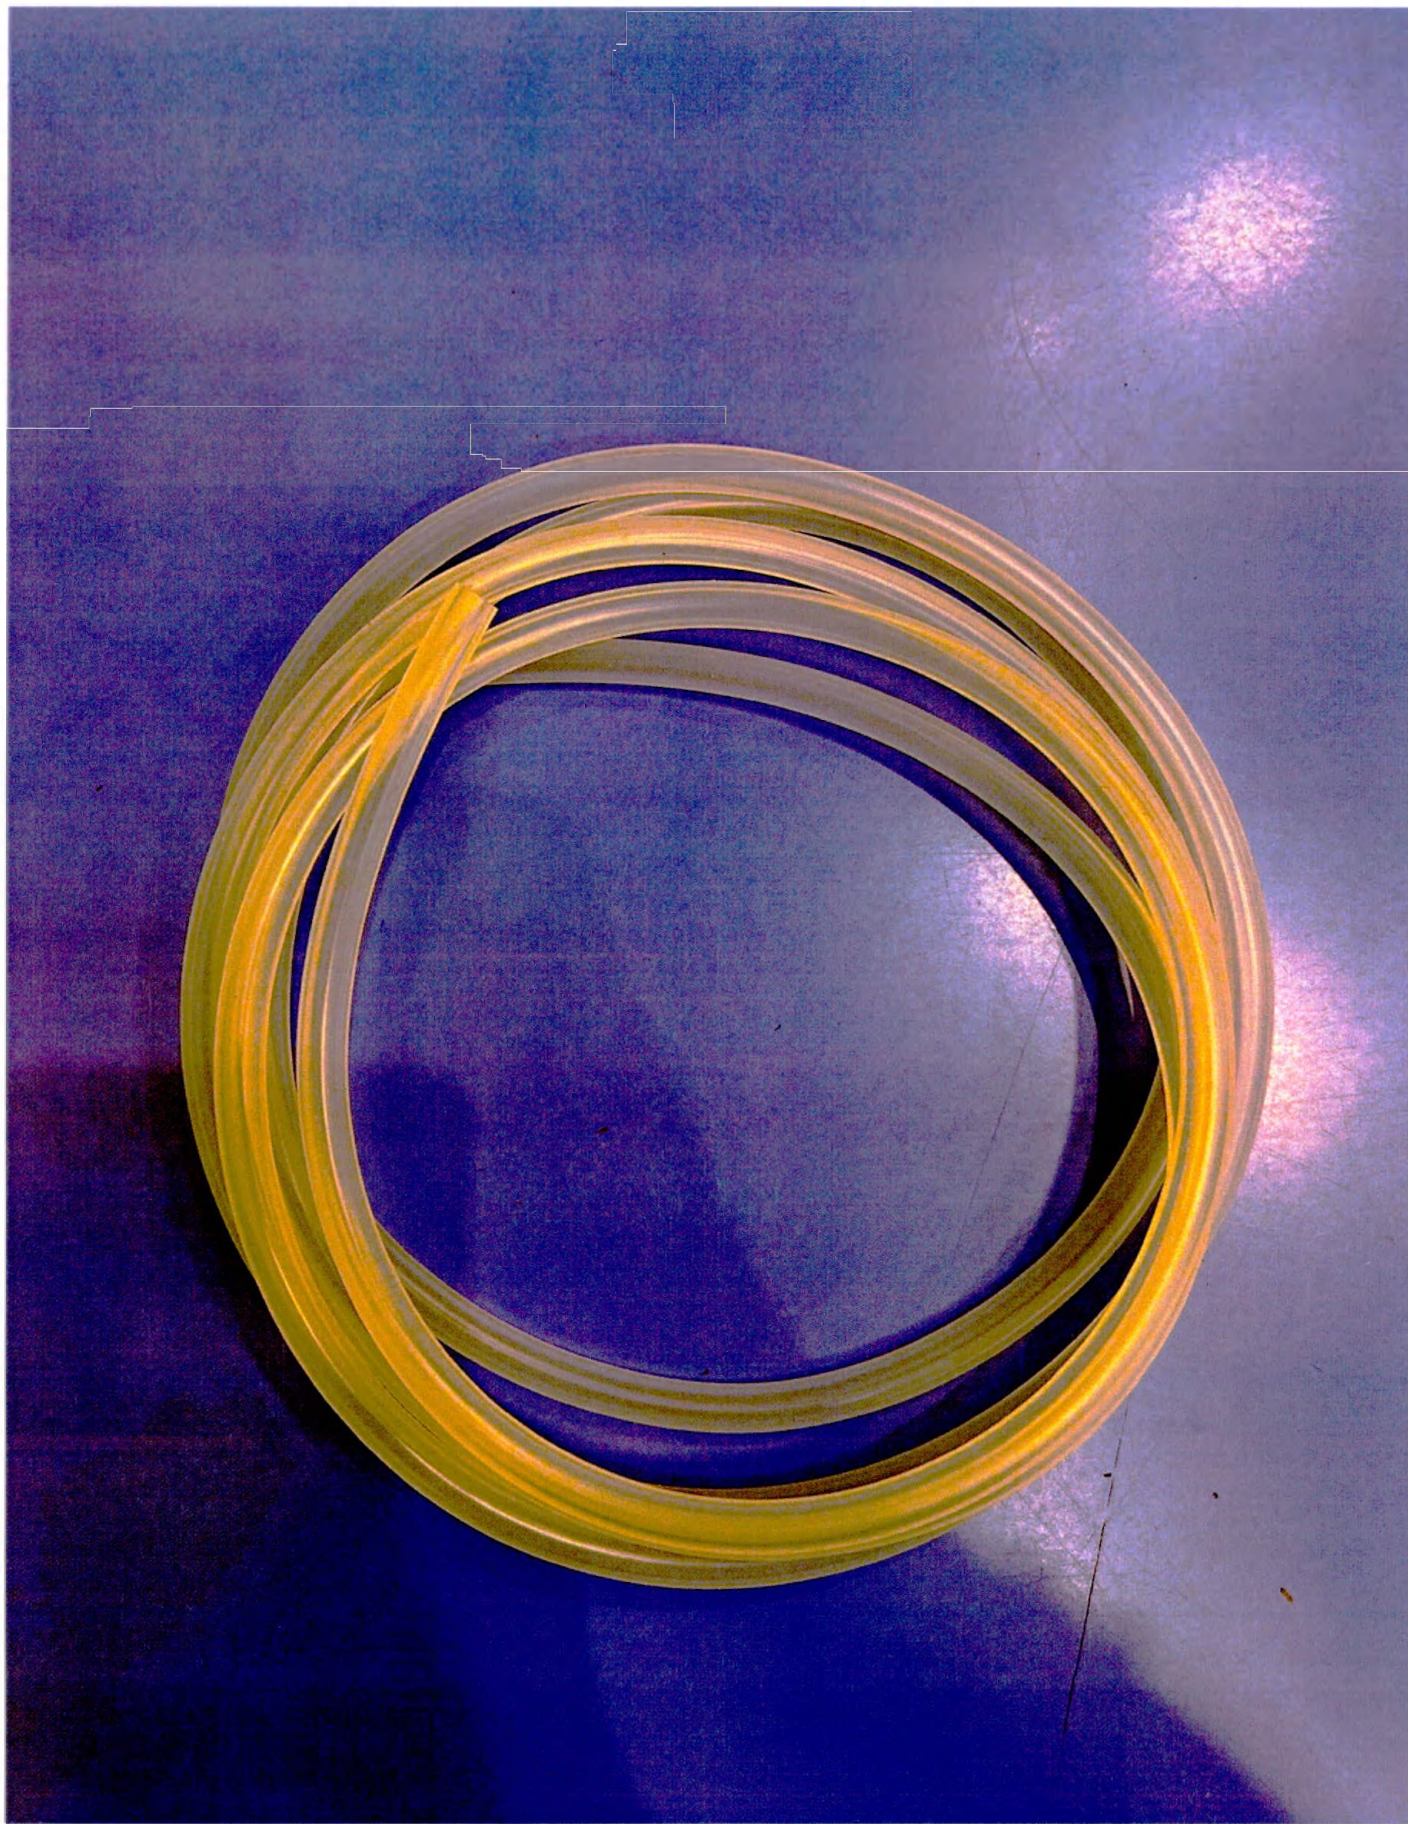


Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Трубки для контейнера для отходов для хроматографической станции (VCS) – 2 шт. / 1 уп. –
1 уп. (при необходимости)»



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Трубки для контейнера для отходов для хроматографической станции (VCS) – 2 шт. / 1 уп. – 1 уп. (при необходимости)»

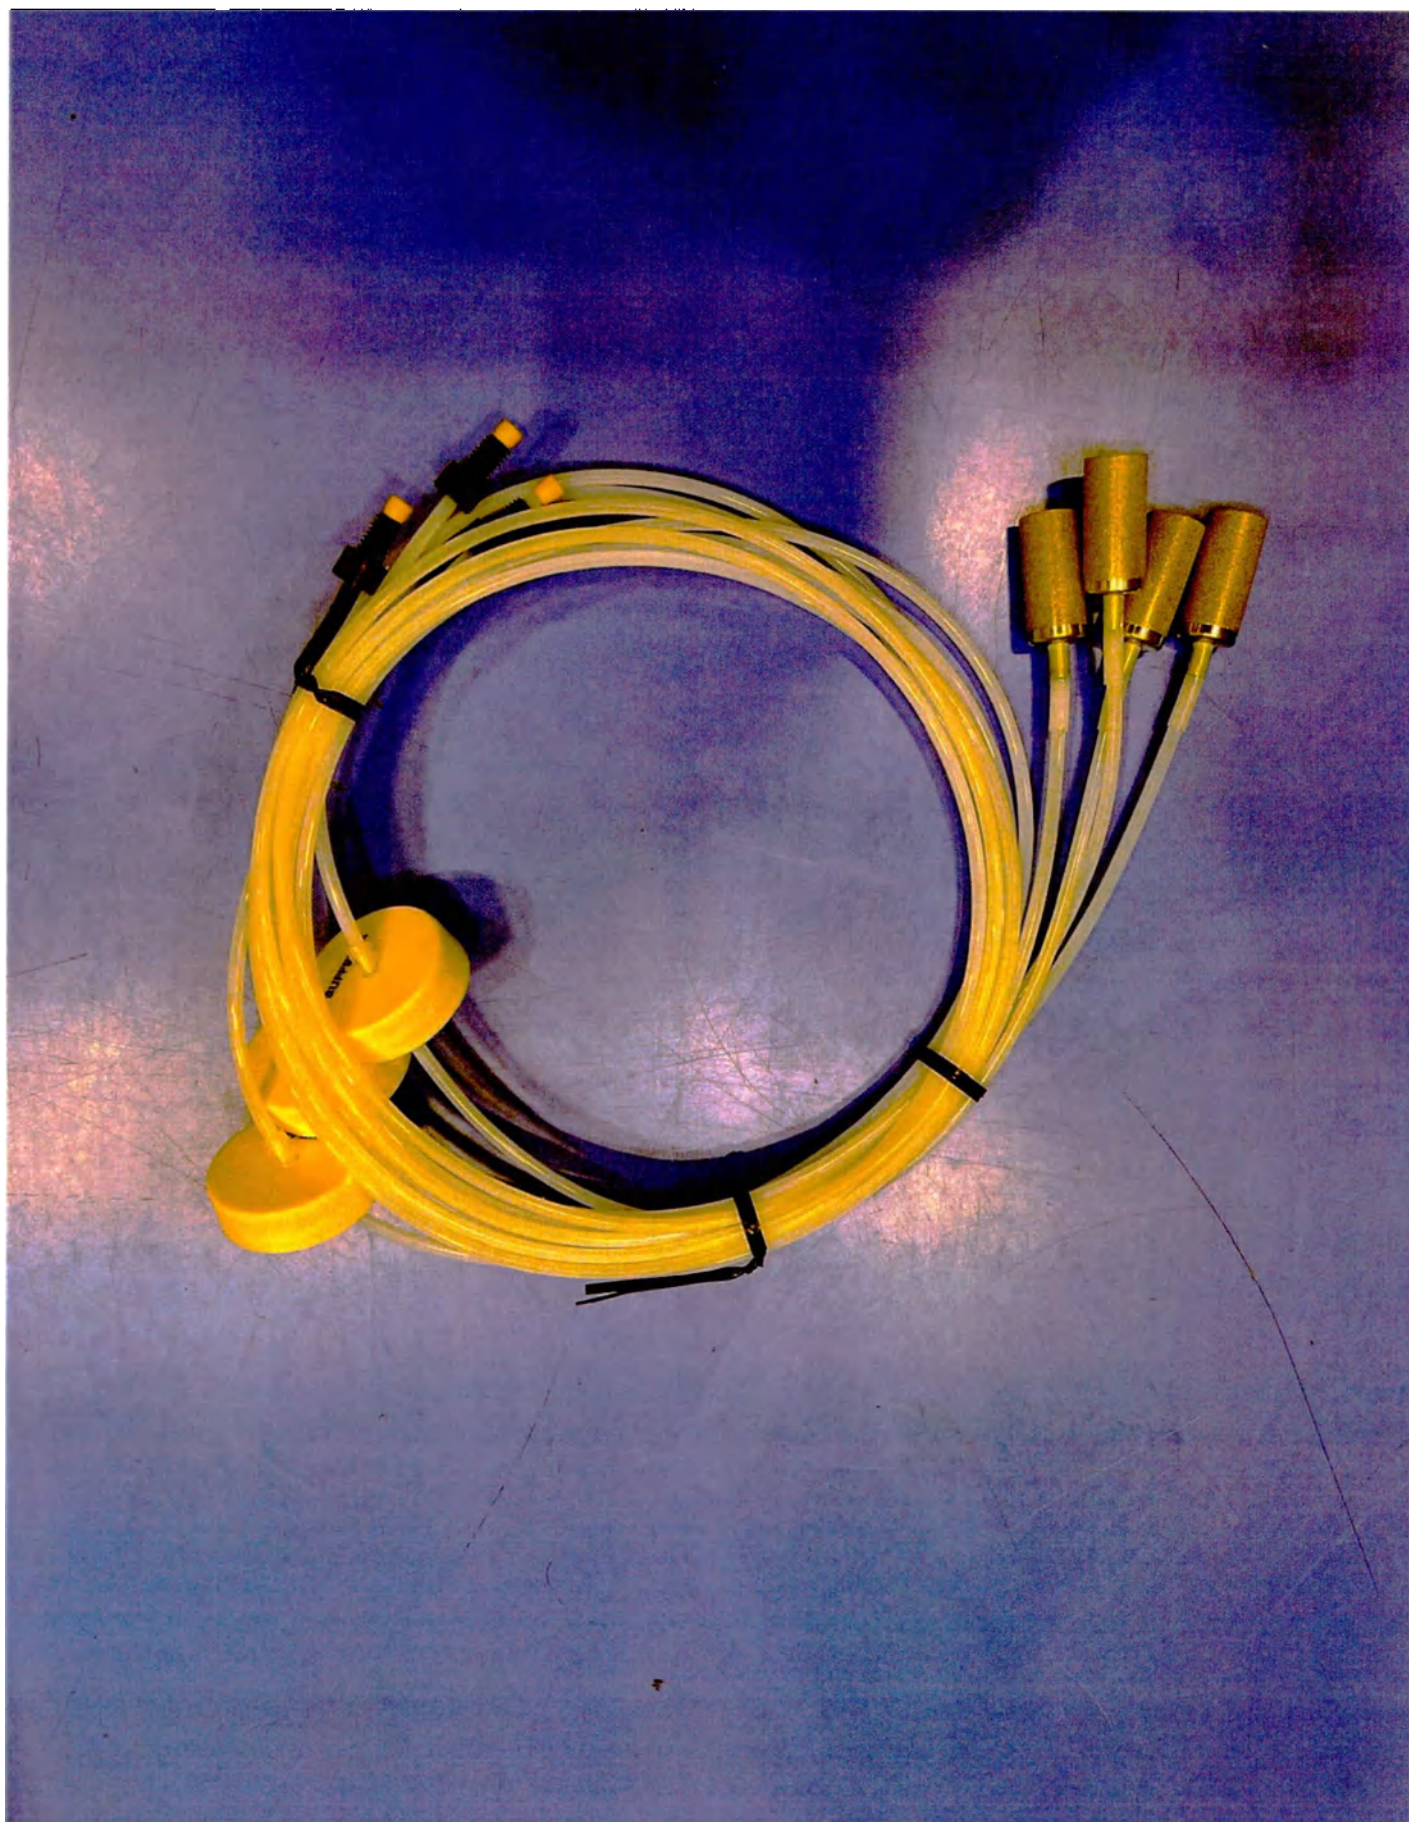


**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«VARIANT II TURBO Буферные трубки с фильтрами для растворителей (10мк) – 1 уп. (при
необходимости)»**

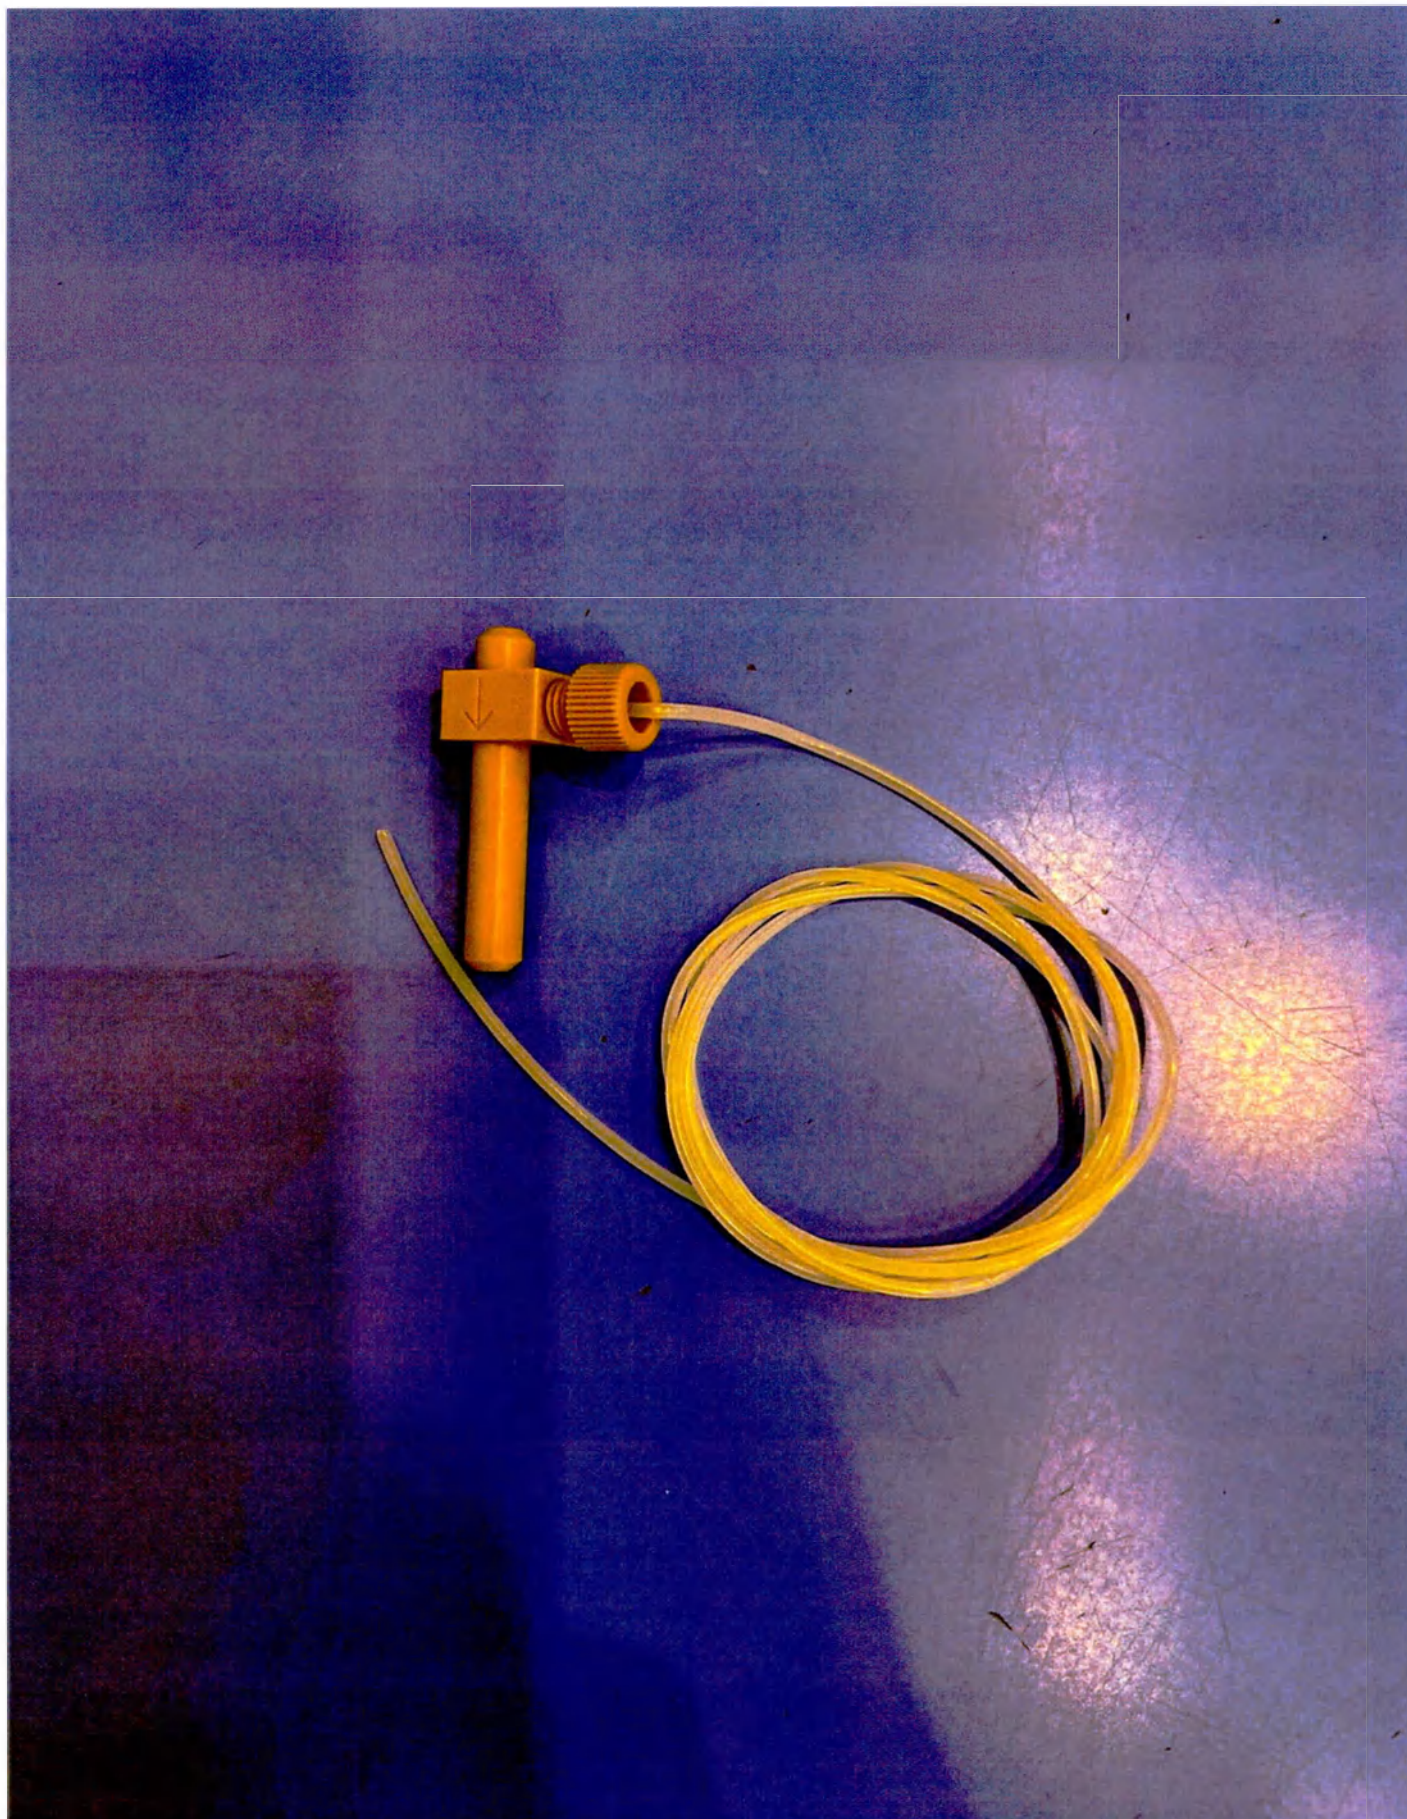


Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «EZR
Картридж с трубкой для проведения процедуры деконтаминации – 1 шт. (при необходимости)»



**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Пластиковые шприцы – 2 шт. (при необходимости)»**

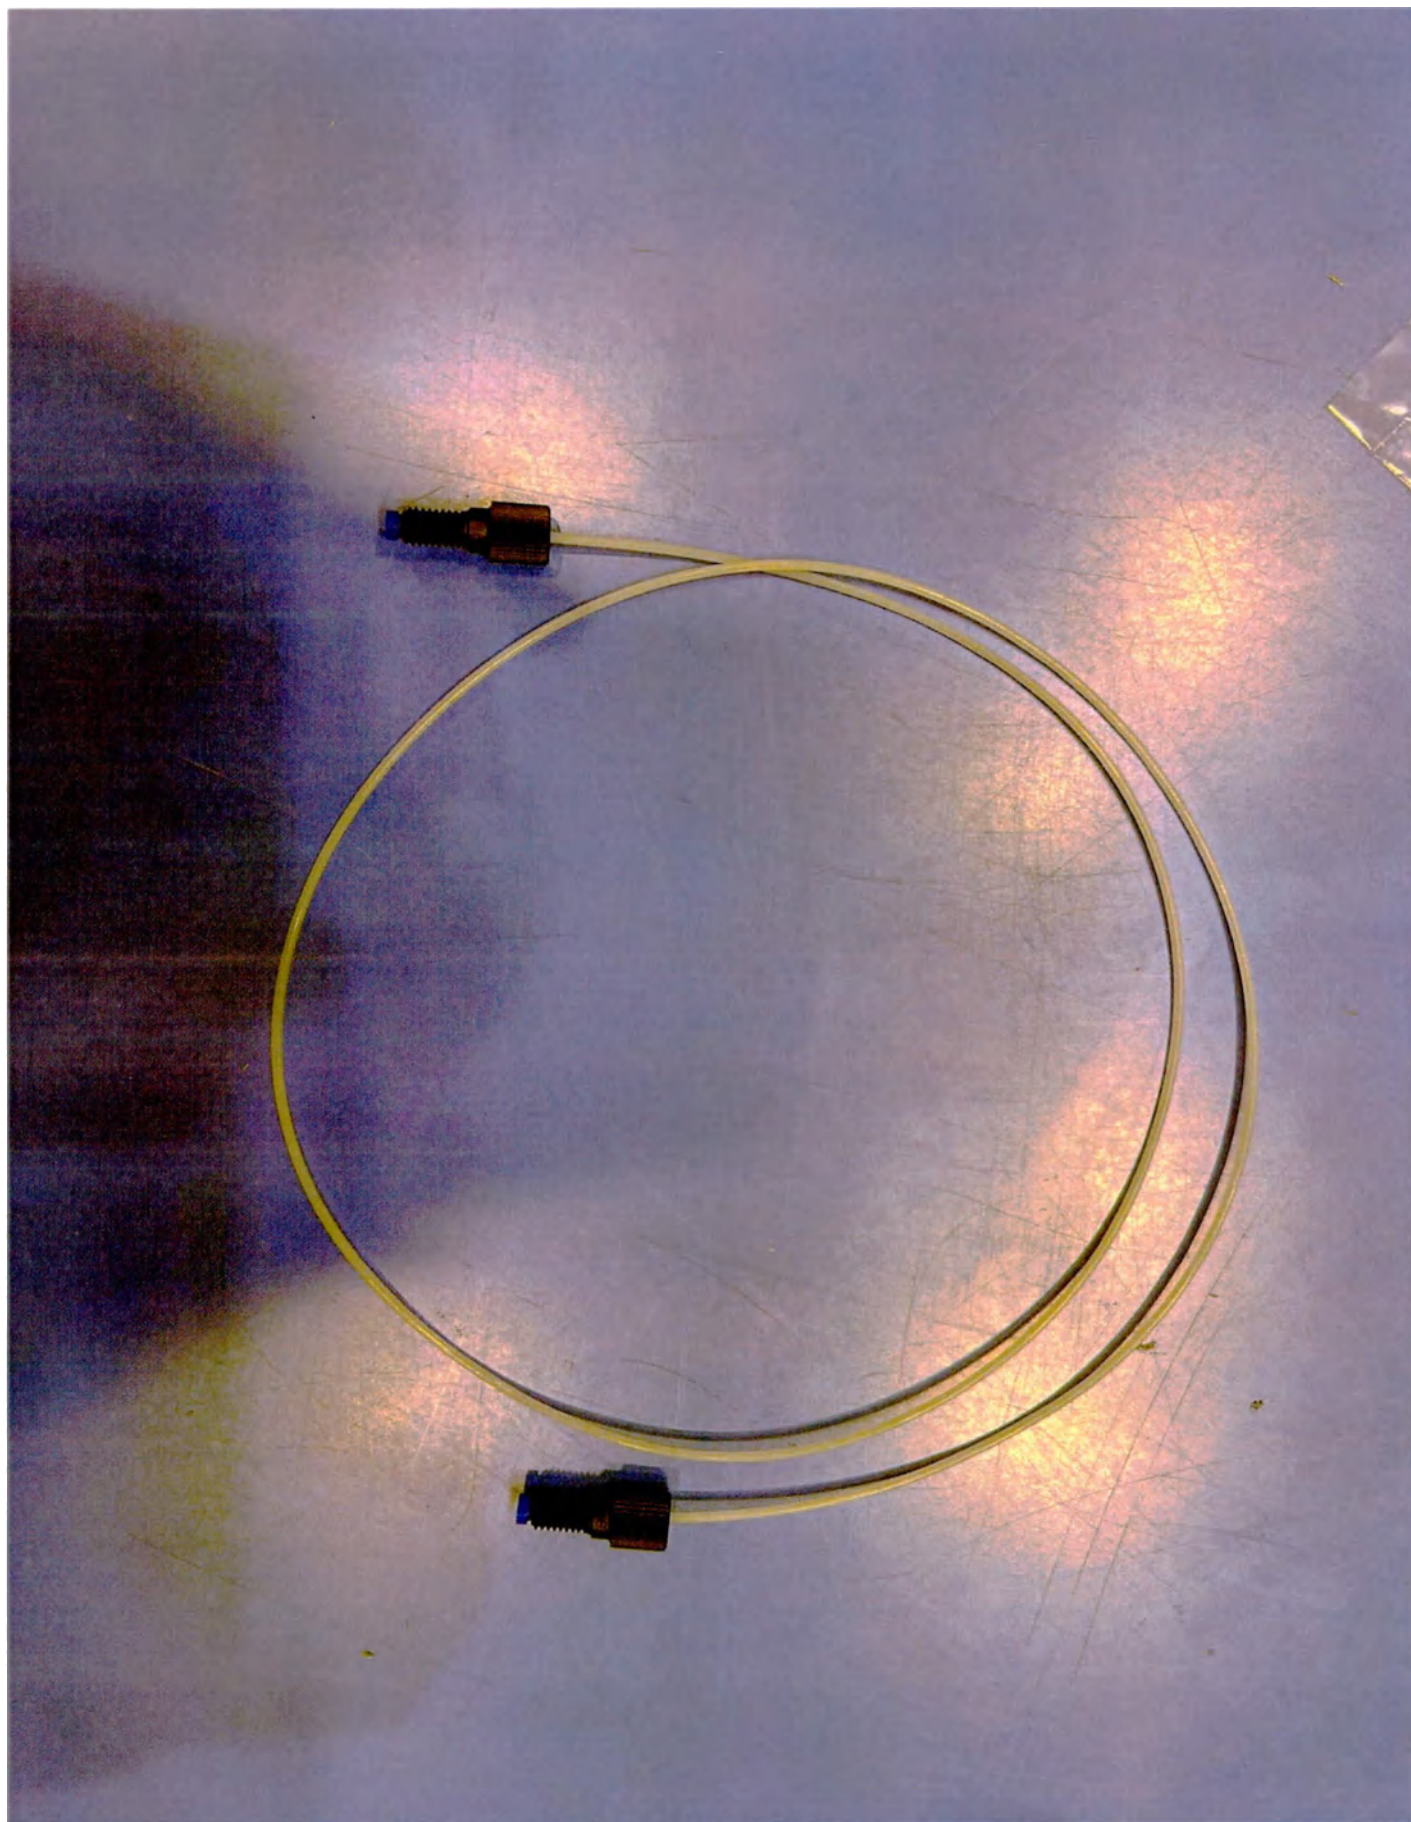

**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Магистральная трубка для образца – 1 шт. (при необходимости)»**

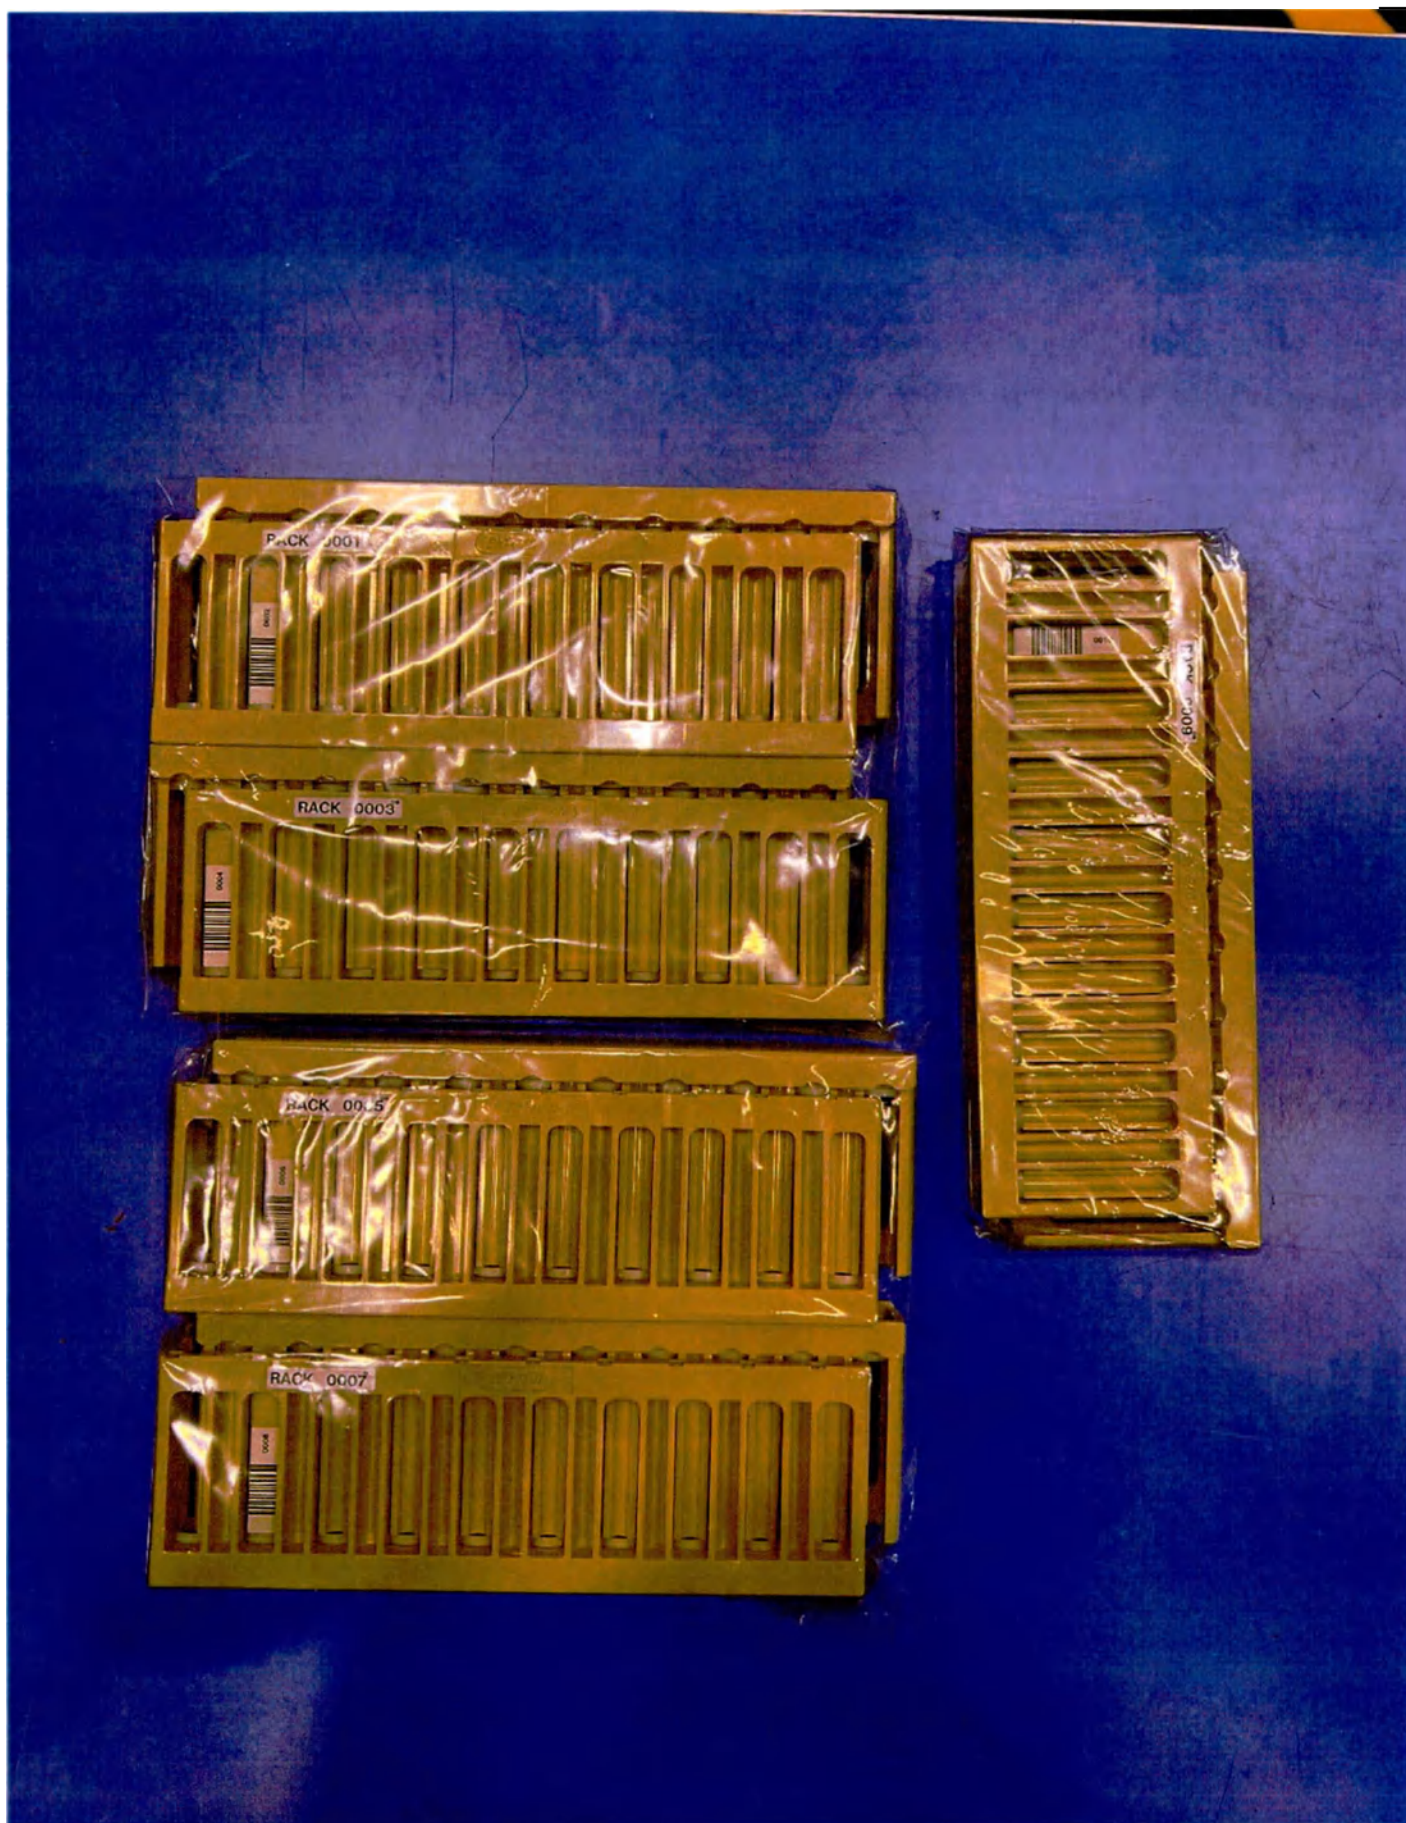

**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Штативы для образцов – 10 шт.»**




**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Вкладыши для штативов для образцов, диаметр 12 мм –1 уп.»**



**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Вкладыши для штативов для образцов, диаметр 13 мм –1 уп.»**



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Вкладыши для штативов для образцов, диаметр 14 мм –1 уп.»

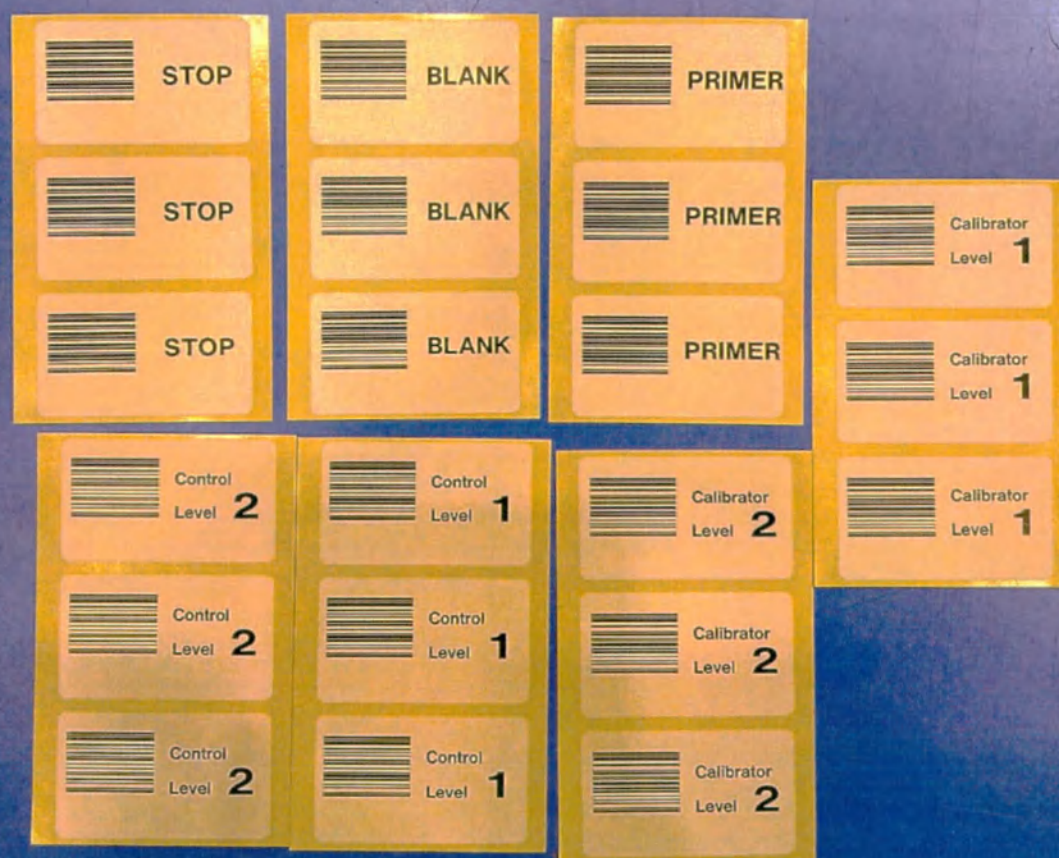

**Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Наклейки с штрихкодами – 1 уп. (при необходимости)»**



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Адаптеры для микропробирок – не более 2 уп.»

BIO-RAD

Catalog No.	Item Description
270-2000	VARIANT II Hemoglobin Testing System Sampling Station

Tab. 1-1 Table of Hazardous Substances

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6)	Polybrominate d Biphenyls (PBB)	Polybrominate d Diphenyl (PBDE)
Product label, Display seals	○	○	○	○	○	○
Chassis and case	○	○	○	○	○	○
Fan	○	○	○	○	○	○
Power inlet	○	○	○	○	○	○
Fuse holder	○	○	○	○	○	○
Power switch	○	○	○	○	○	○
Fuses	○	○	○	○	○	○
Power cable	○	○	○	○	○	○
Power supply unit	○	○	○	○	○	○
Communication cables	○	○	○	○	○	○
Communication ports	○	○	○	○	○	○
Inside wiring cables/connectors	○	○	○	○	○	○
Stepping motors	○	○	○	○	○	○
DC motor	○	○	○	○	○	○
Barcode reader	○	○	○	○	○	○
Pinch valve	○	○	○	○	○	○
Vacuum pump	○	○	○	○	○	○
Floating switch	○	○	○	○	○	○
Main PC board (#240)	○	○	○	○	○	○
Sub PC board (#253, #276)	○	○	○	○	○	○
Sub PC board (#254)	○	○	○	○	○	○
Sub PC board (#255)	○	○	○	○	○	○
Sub PC board (#256)	○	○	○	○	○	○
Syringe pump unit	○	○	○	○	○	○
Mixing head	○	○	○	○	○	○
Y-Z drive mechanism	○	○	○	○	○	○
Tube holder	○	○	○	○	○	○
Dilution chamber	○	○	○	○	○	○
Rack carrier drive mechanism	○	○	○	○	○	○
Plumbing parts	○	○	○	○	○	○
Conveyor belt unit	○	○	○	○	○	○
Sample racks	○	○	○	○	○	○
Screws	○	○	○	○	○	○

○ : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all the homogeneous materials for this part, according to EIP-A, EIP-B, EIP-C is below the limit requirement in GB/T26572.

× : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all the homogeneous materials for this part, according to EIP-A, EIP-B, EIP-C is above the limit requirement in GB/T26572.

The cable assembly from the display to the Main PCA is included in the Display PCA declaration.

Tab. 1-2 Pollution control logo

The environmentally friendly use period (EFUP) is the number from the date of manufacture that hazardous substances contained in electronic information products will not leak or mutate under normal operating conditions.



L70216400revA

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Таблица опасных веществ для станции отбора образцов (VSS) на бумажном носителе – 1 шт.»

BIO-RAD

Catalog No.	Item Description
270-2000	VARIANT II Hemoglobin Testing System Chromatographic Station

Tab. 1-1 Table of Hazardous Substances

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6)	Polybrominate d Biphenyls (PBB)	Polybrominate d Diphenyl (PBDE)
Product label, Display seals	o	o	o	o	o	o
Chassis and case	o	o	o	o	o	o
Fan	o	o	o	o	o	o
Power inlet	o	o	o	o	o	o
Fuse holder	o	o	o	o	o	o
Power switch	o	o	o	o	o	o
Fuses	o	o	o	o	o	o
Power cable	o	o	o	o	o	o
Power supply unit	o	o	o	o	o	o
Communication cables	o	o	o	o	o	o
Communication ports	o	o	o	o	o	o
Inside wiring cables/connectors	o	o	o	o	o	o
Stepping motors	o	o	o	o	o	o
Injection valve	o	o	o	o	o	o
Solenoid valves	o	o	o	o	o	o
Vacuum pump	o	o	o	o	o	o
Pressure sensor	o	o	o	o	o	o
Strain gauge sensor	o	o	o	o	o	o
Floating switch	o	o	o	o	o	o
Terminal	o	o	o	o	o	o
Hb Detector PC board	o	o	o	o	o	o
Main CPU PC board	o	o	o	o	o	o
Mother PC board	o	o	o	o	o	o
Pump control PC board	o	o	o	o	o	o
Power supply PC board	o	o	o	o	o	o
Degasser PC board	o	o	o	o	o	o
Connector translation PC board	o	o	o	o	o	o
Reservoir PC board	o	o	o	o	o	o
Syringe pump unit	o	o	o	o	o	o
High pressure pump unit	o	o	o	o	o	o
Degasser unit	o	o	o	o	o	o
Column heater unit	o	o	o	o	o	o
Hemoglobin detector unit	x	o	x	o	o	o
Mixer unit	o	o	o	o	o	o
Reservoir unit	o	o	o	o	o	o
Plumbing parts	o	o	o	o	o	o
Accessory parts	o	o	o	o	o	o
Waste tank	o	o	o	o	o	o
Column holder	o	o	o	o	o	o
Screws	o	o	o	o	o	o

o : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all the homogeneous materials for this part, according to EIP-A, EIP-B, EIP-C is below the limit requirement in GB/T26572.

x : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all the homogeneous materials for this part, according to EIP-A, EIP-B, EIP-C is above the limit requirement in GB/T26572.

The cable assembly from the display to the Main PCA is included in the Display PCA declaration.


Tab. 1-2 Pollution control logo

The environmentally friendly use period (EFUP) is the number from the date of manufacture that hazardous substances contained in electronic information products will not leak or mutate under normal operating conditions.


L70216500revA



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Таблица опасных веществ для хроматографической станции (VCS) на бумажном носителе – 1 шт.»

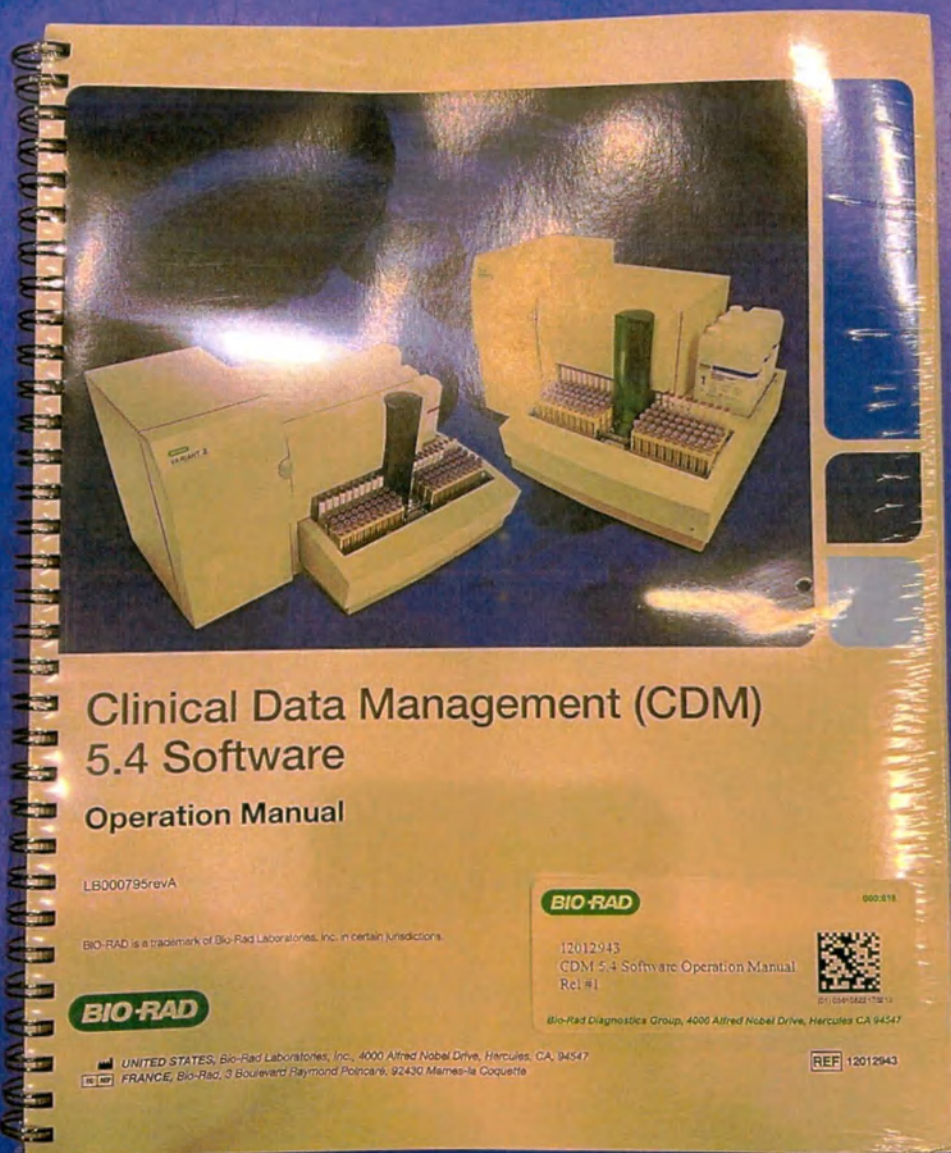

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Руководство пользователя программного обеспечения Clinical Data Management (CDM) на
бумажном носителе - 1 шт.»

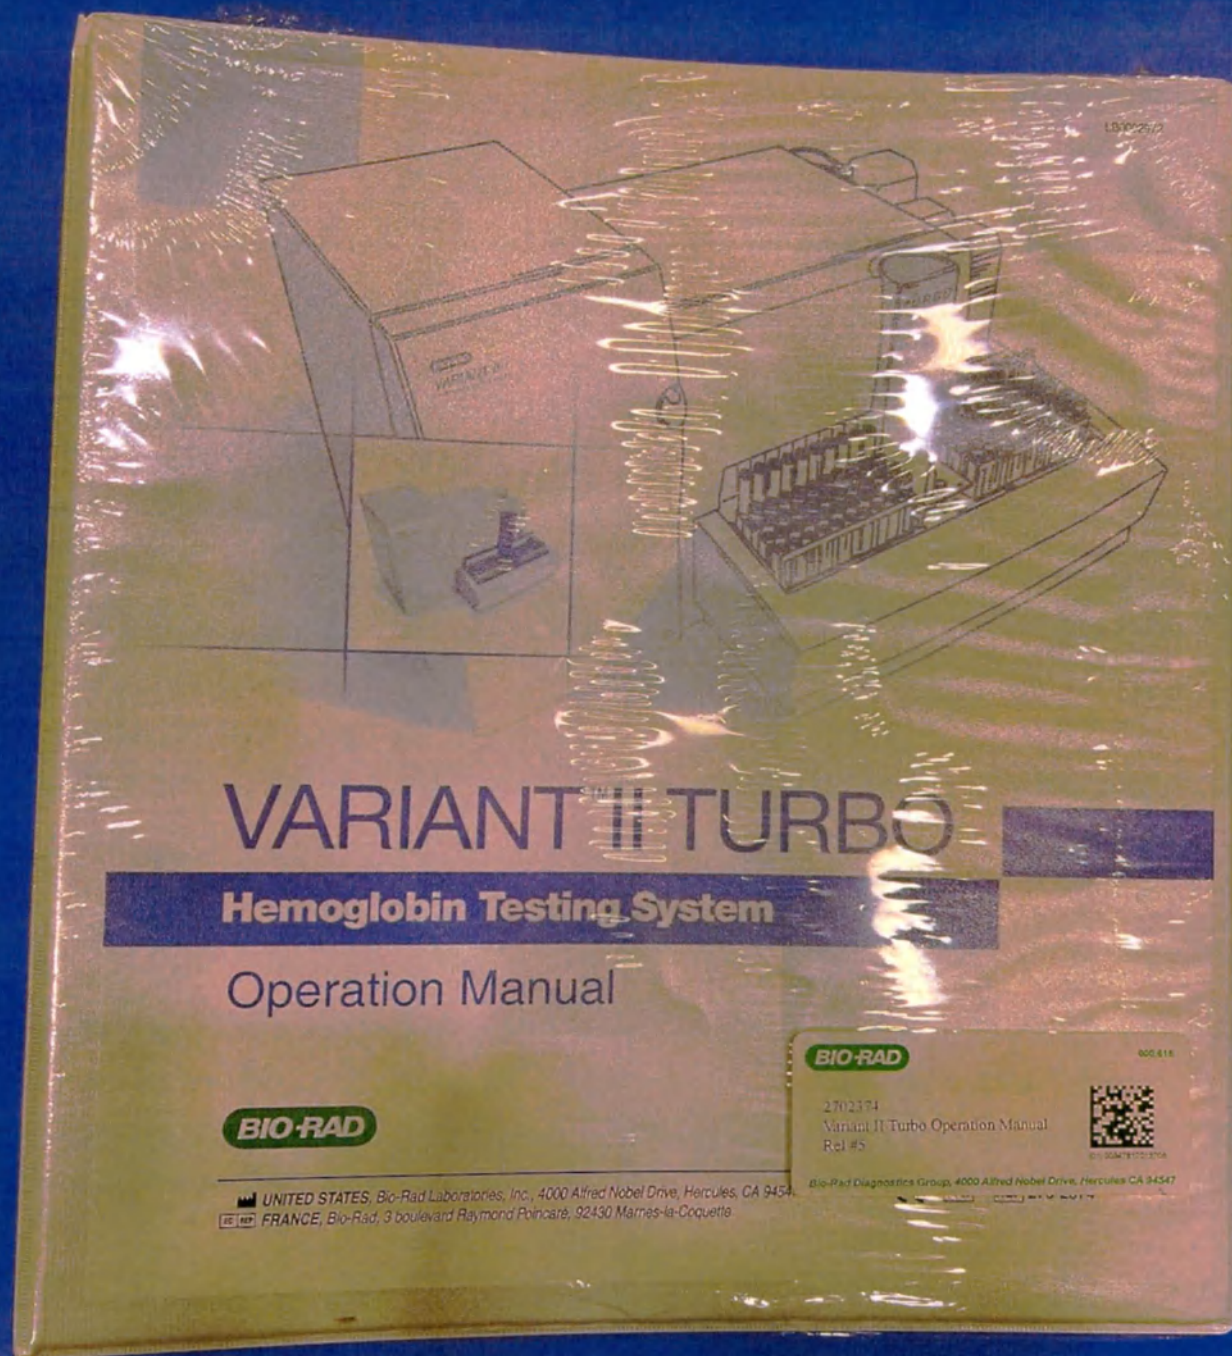

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System:
«Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.»

Bio-Rad Diagnostics Group System & Instrument Warranty Registration

Upon receipt of your system or instrument, please complete and send this registration form to Bio-Rad Laboratories.

Please read the information on the reverse side for an explanation of the warranty coverage and suggested steps for handling system or instrument problems.

Please print or type all information

Purchase Order Number _____

Invoice Number _____

Company Name _____

Department _____

Address _____

City _____ State _____ ZIP _____

Country _____

Phone/Extension () _____ x. _____

E-mail Address _____

International Calling Code _____

Fax Number _____

Contact Name(s) _____

System or Instrument Location (e.g., laboratory, room no.) _____

Date Unit Installed _____

Name of Installer _____

Signature of Installer _____

Systems

	Cat# 110V	Cat# 220V	Serial #
	(please circle number)		
1. AutoPrep™	210-0500	same	_____
2. CODA™ System			
w/Data Station	402-5801	402-5802	_____
Instrument Only	402-5801D	402-5802D	_____
3. DiaSTAT™ Analyzer	210-0001	same	_____
4. Genepath Gel Doc			
w/Computer	310-0189	-----	_____
without Computer	310-0130	310-0131	_____
5. Model 60 Dispenser	210-0075	same	_____
6. REMEDI™ HS	195-7103	195-7104	_____
7. VARIANT™ Express	220-0001	220-0002	_____
8. VARIANT™	270-0001	270-0021D	_____
9. VARIANT™ II System			
w/Computer	270-2000	same	_____
without Computer	270-2001	same	_____
10. Other _____			_____

Instruments

	Cat# 110V	Cat# 220V	Serial #
	(please circle number)		
1. AS-100 Automatic Sampler	195-5170	195-5171	_____
2. Benchmark Microplate Reader	402-6686	same	_____
3. CDM™ Computer	195-5259	same	_____
4. CDM™ Printer	195-5260	N/A	_____
5. CODA™ Data Station	402-5805	same	_____
6. Column Heater	195-5022	195-5130	_____
7. CR501 Chromatopac Integrator	196-5145	same	_____
8. FlexiSpot Puncher Dispenser	800-00140	same	_____
9. Manual Injector/Purge Valve Assembly	195-5147	same	_____
10. MICROTACH Microplate Washer	402-6723	402-6724	_____
11. Model 237 Incubator	402-6721	402-6722	_____
12. Model 550 Microplate Reader	402-6683	same	_____
13. Model 1575 Microplate Washer	402-6684	same	_____
14. Model 1350 Soft-Start Pump	195-0302	same	_____
15. Model 1640 EC Detector	195-5026	same	_____
16. Model 1801 UV Monitor	195-5193	same	_____
17. REMEDI™ Centrifuge	195-7514	195-7519	_____
18. REMEDI™ HS CPU	195-7183	same	_____
19. REMEDI™ Power Conditioner	195-7185	195-7185/6	_____
20. REMEDI™ UPS	N/A	195-7341	_____
21. Other _____			_____
22. Other _____			_____

BIO-RAD

Diagnostics
Group

000 087-3

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Комплект сопроводительной технической документации – 1 уп. (при необходимости)»



Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «CD-диск для сервисного обслуживания – 1 шт. (при необходимости)»

Bio-Rad A1c

BE THE DIFFERENCE

BIO-RAD

L95415601

Компонент системы автоматической VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System: «Коврик для компьютерной мыши – 1 шт. (при необходимости)»



Транспортная упаковка медицинского изделия



Врашников

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 48 ЛИСТА «ОВ»

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 19/2024
ОТ 01.12.2025