

Фотографические изображения медицинского изделия

«Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый для сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D), в вариантах исполнения»

производства «Кардиак Пейсмейкерс., Инк.» дочернее предприятие со стопроцентным участием «Гайдант Корпорейшн» дочернего предприятия со стопроцентным участием компании «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США / Cardiac Pacemakers, Inc. a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation, USA

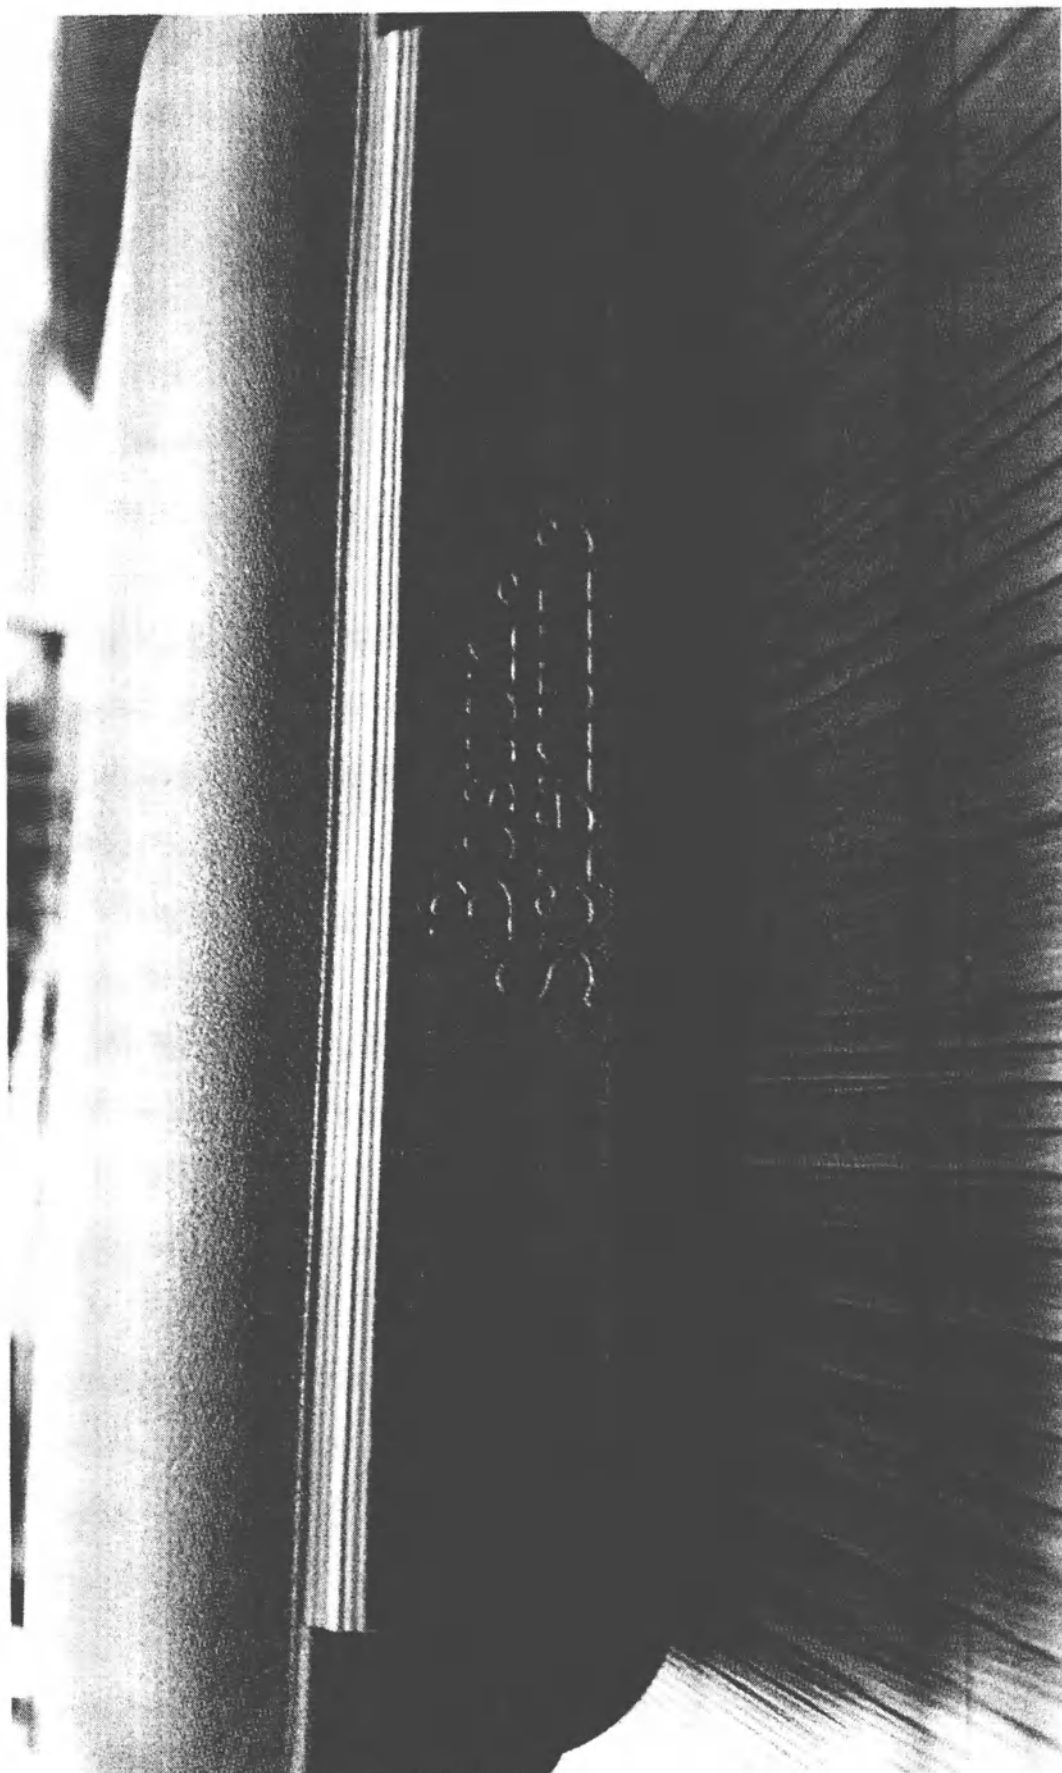


Фото 1. Товарная упаковка, все варианты исполнения. Товарный знак производителя на крышке.



Фото 2. Изделие в первичной упаковке, все варианты исполнения.




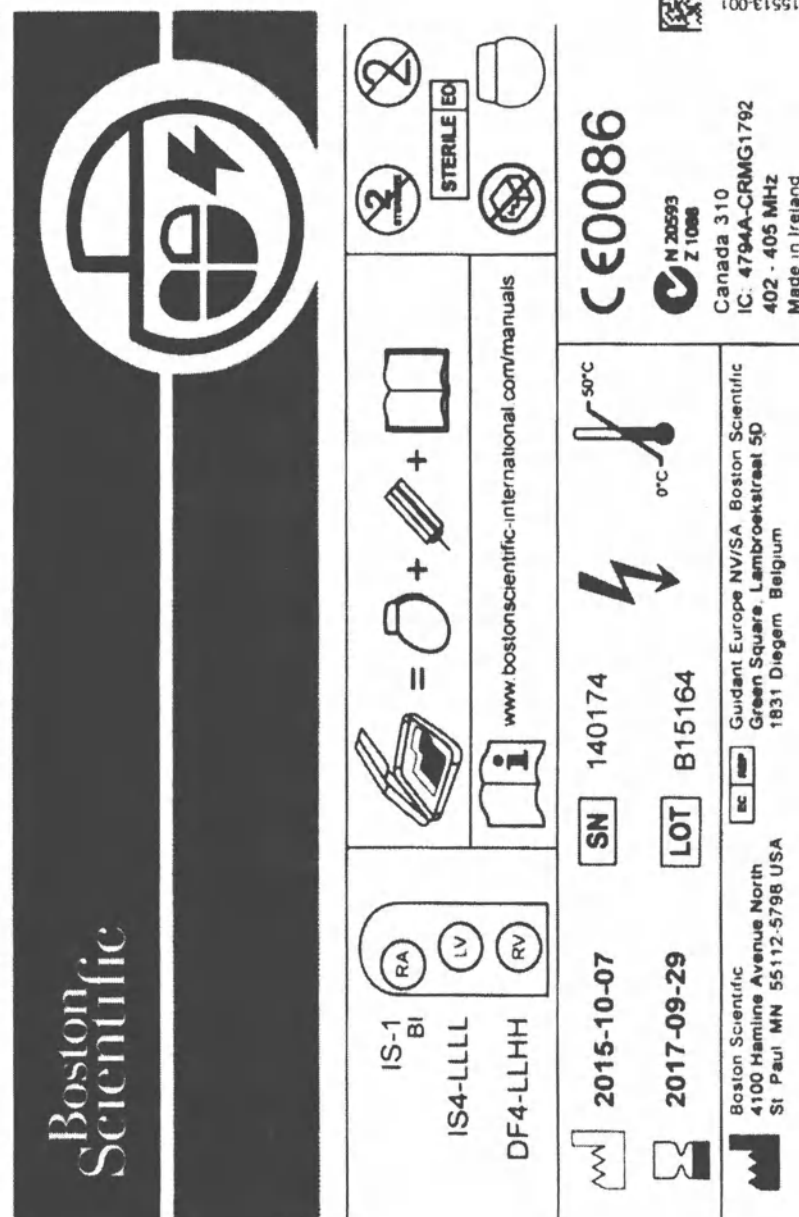


Фото 3. Товарная упаковка, вариант исполнения AUTOGEN X4 CRT-D (MRI) модель G179, верх.

Boston
Scientific

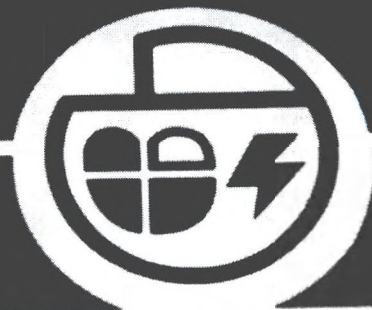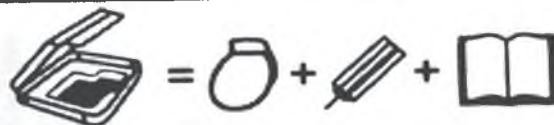

IS-1
BI
IS4-LLLL
DF4-LLHH



www.bostonscientific-international.com/manuals




STERILE EO



2016-03-22

SN

146830



2018-03-07

LOT

A16345



Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guident Europe NV/SA, Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 50
1831 Diegem, Belgium

CE0086

N 20593
Z 1068

Canada 310
IC: 4794A-CRMG1792
402 - 405 MHz
Made in Ireland



15025-001
EN EU

Фото 4. Товарная упаковка, вариант исполнения DYNAGEN X4 CRT-D (MRI)
модель G158, верх

Boston
Scientific

en

Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator

Characteristics as shipped

Tachy Mode Storage
Tachy Therapy Available Shock, ATP
Pacing Mode Storage
Pacing Therapy DDDR
Sensor Accelerometer
Pace/Sense Configuration RA: BUI RV: BUI LV: BUI

Symbols that may be used on packaging

Refer to the System/Reference Guide for all programmable parameters and values.
If the container seal is broken, Boston Scientific will not accept contents for credit or restock.
Caution: Do not store near magnets or magnetic devices.

Фото 5. Товарная упаковка, вариант исполнения DYNAGEN X4 CRT-D (MRI) модель G158, низ.



Фото 6. Товарная упаковка, вариант исполнения DYNAGEN X4 CRT-D (MRI)
модель G158, боковая маркировка.

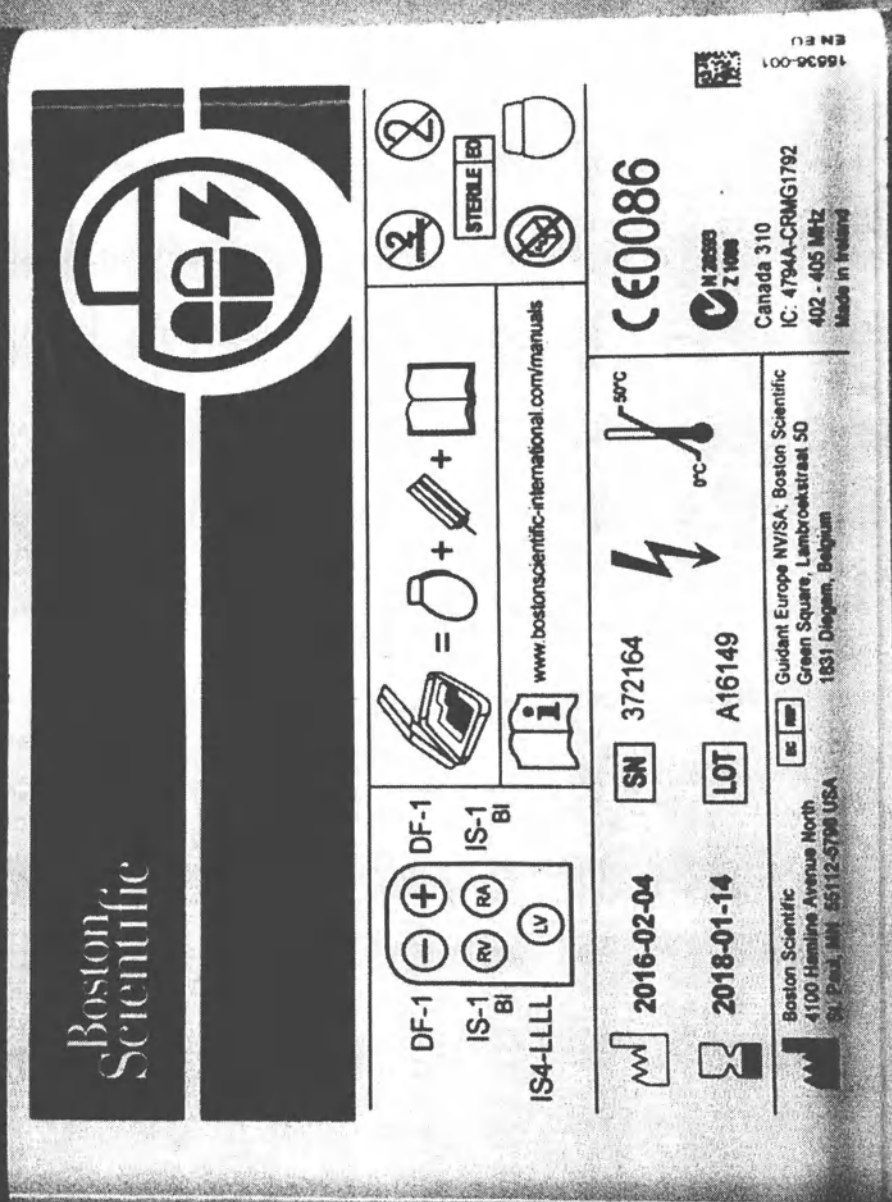


Фото 7. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D модель G146, верх.

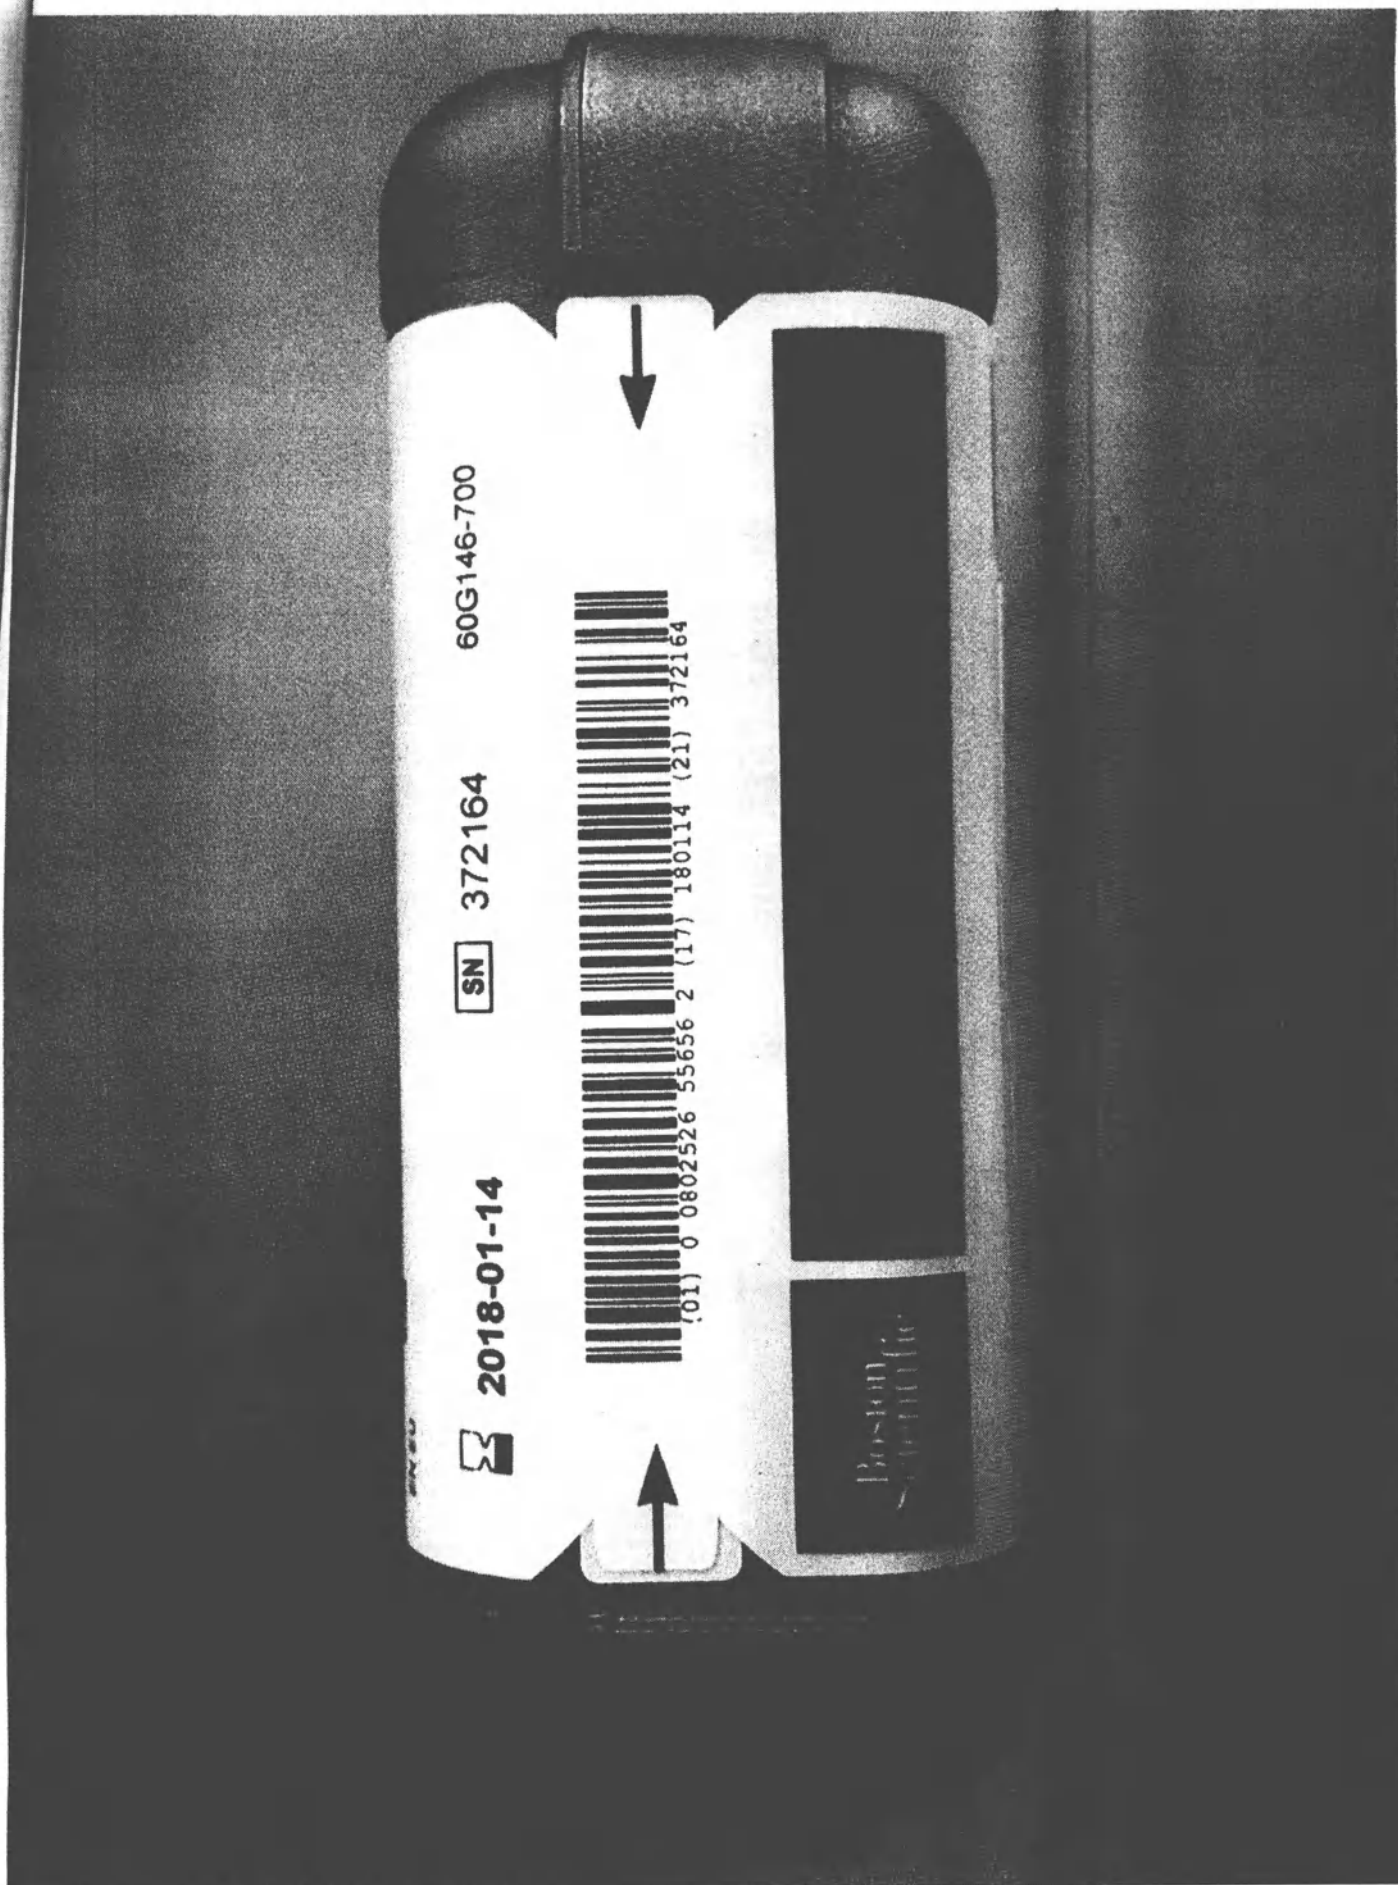


Фото 8. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D модель G146, боковая маркировка.

Boston
Scientific




Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator

en

Characteristics as shipped

Tachy Mode Storage
Tachy Therapy Available Shock, ATP
Pacing Mode Storage
Pacing Therapy DDDR
Sensor Accelerometer
Pace/Sense Configuration RA: BUI RV: BUI LV: BUI

Symbols that may be used on packaging

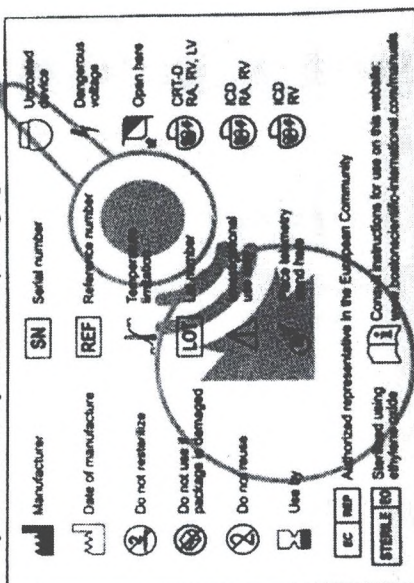

Refer to the System/Reference Guide for all programmable parameters and values.
If the container seal is broken, Boston Scientific will not accept contents for credit or restock.
Caution: Do not store near magnets or magnetic devices.

328102-001

Фото 9. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D модель G146, низ.

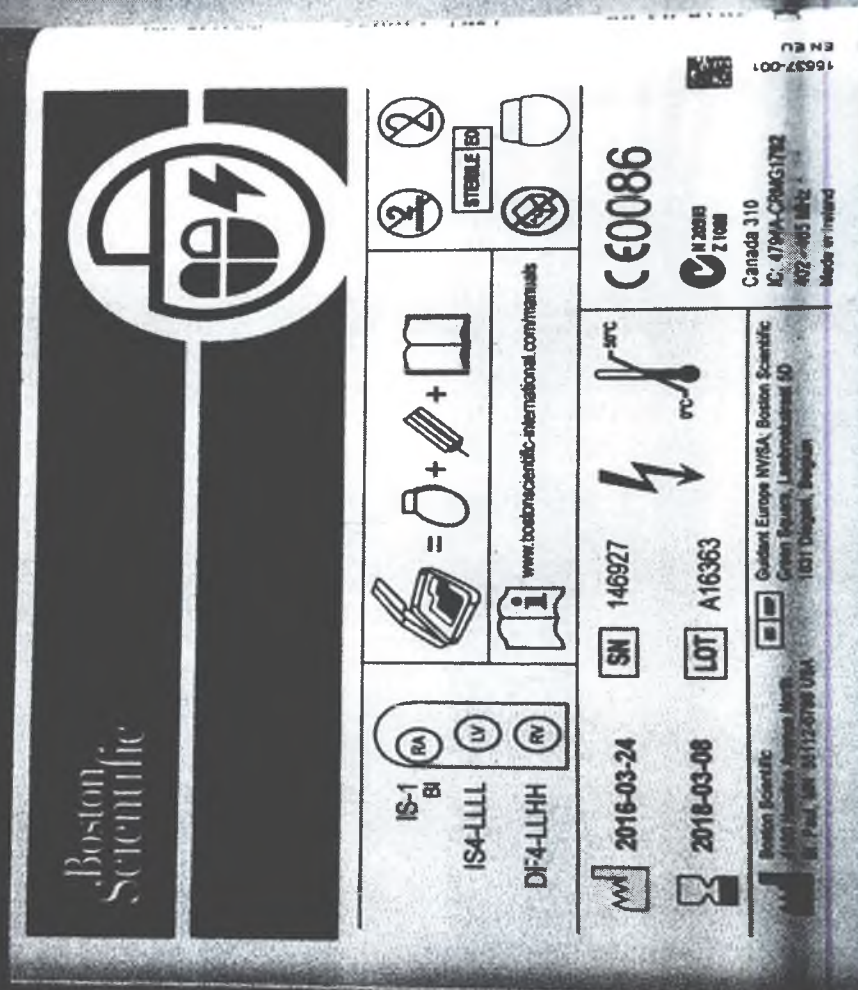


Фото 10. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D (MRI), модель G148, верх.

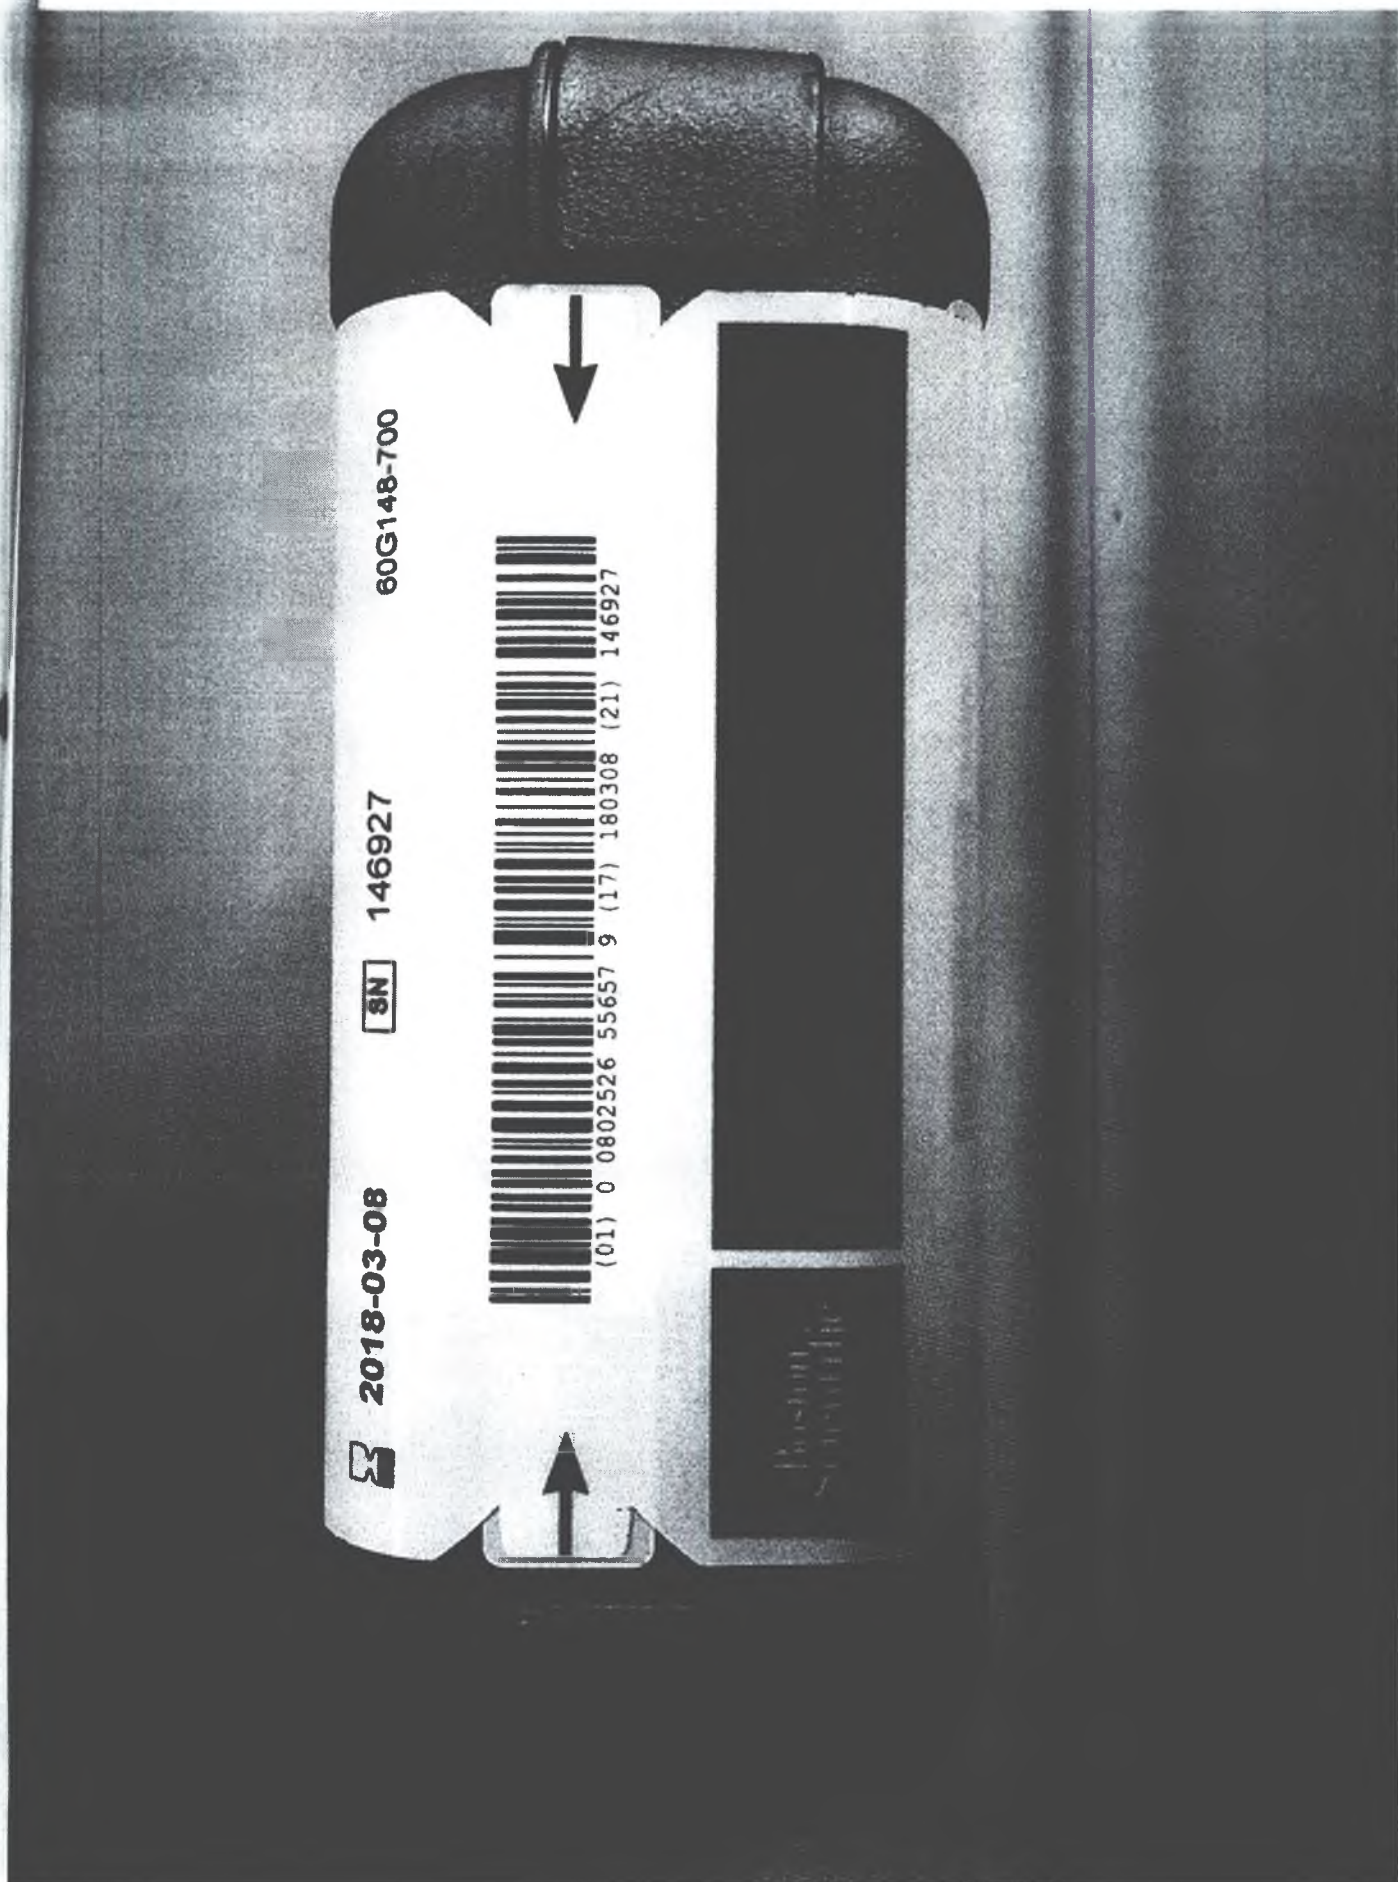


Фото 11. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D (MRI), модель G148, боковая маркировка.

Boston
Scientific

en

Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator

Symbols that may be used on packaging

Manufacturer	SN	Serial number	Unopened device
Date of manufacture	REF	Reference number	Dangerous voltage
Do not reutilize	LOT	Lot number	Open here
Do not use if package is damaged	CRD	CRD RA, RV, LV	CRD RA, RV, LV
Do not reuse	ICD	ICD RA, RV	ICD RA, RV
Use by	ICD	ICD RV	ICD RV

Authorized representative in the European Community

Serial using instructions for use on this website: www.boston-scientific-international.com/manuals

Refer to the SystemReference Guide for all programmable parameters and values.

If the container seal is broken, Boston Scientific will not accept contents for credit or refund.

Caution: Do not store near magnets or magnetic devices.

Фото 12. Товарная упаковка, вариант исполнения INOGEN X4 CRT-D (MRI), модель G148, низ.

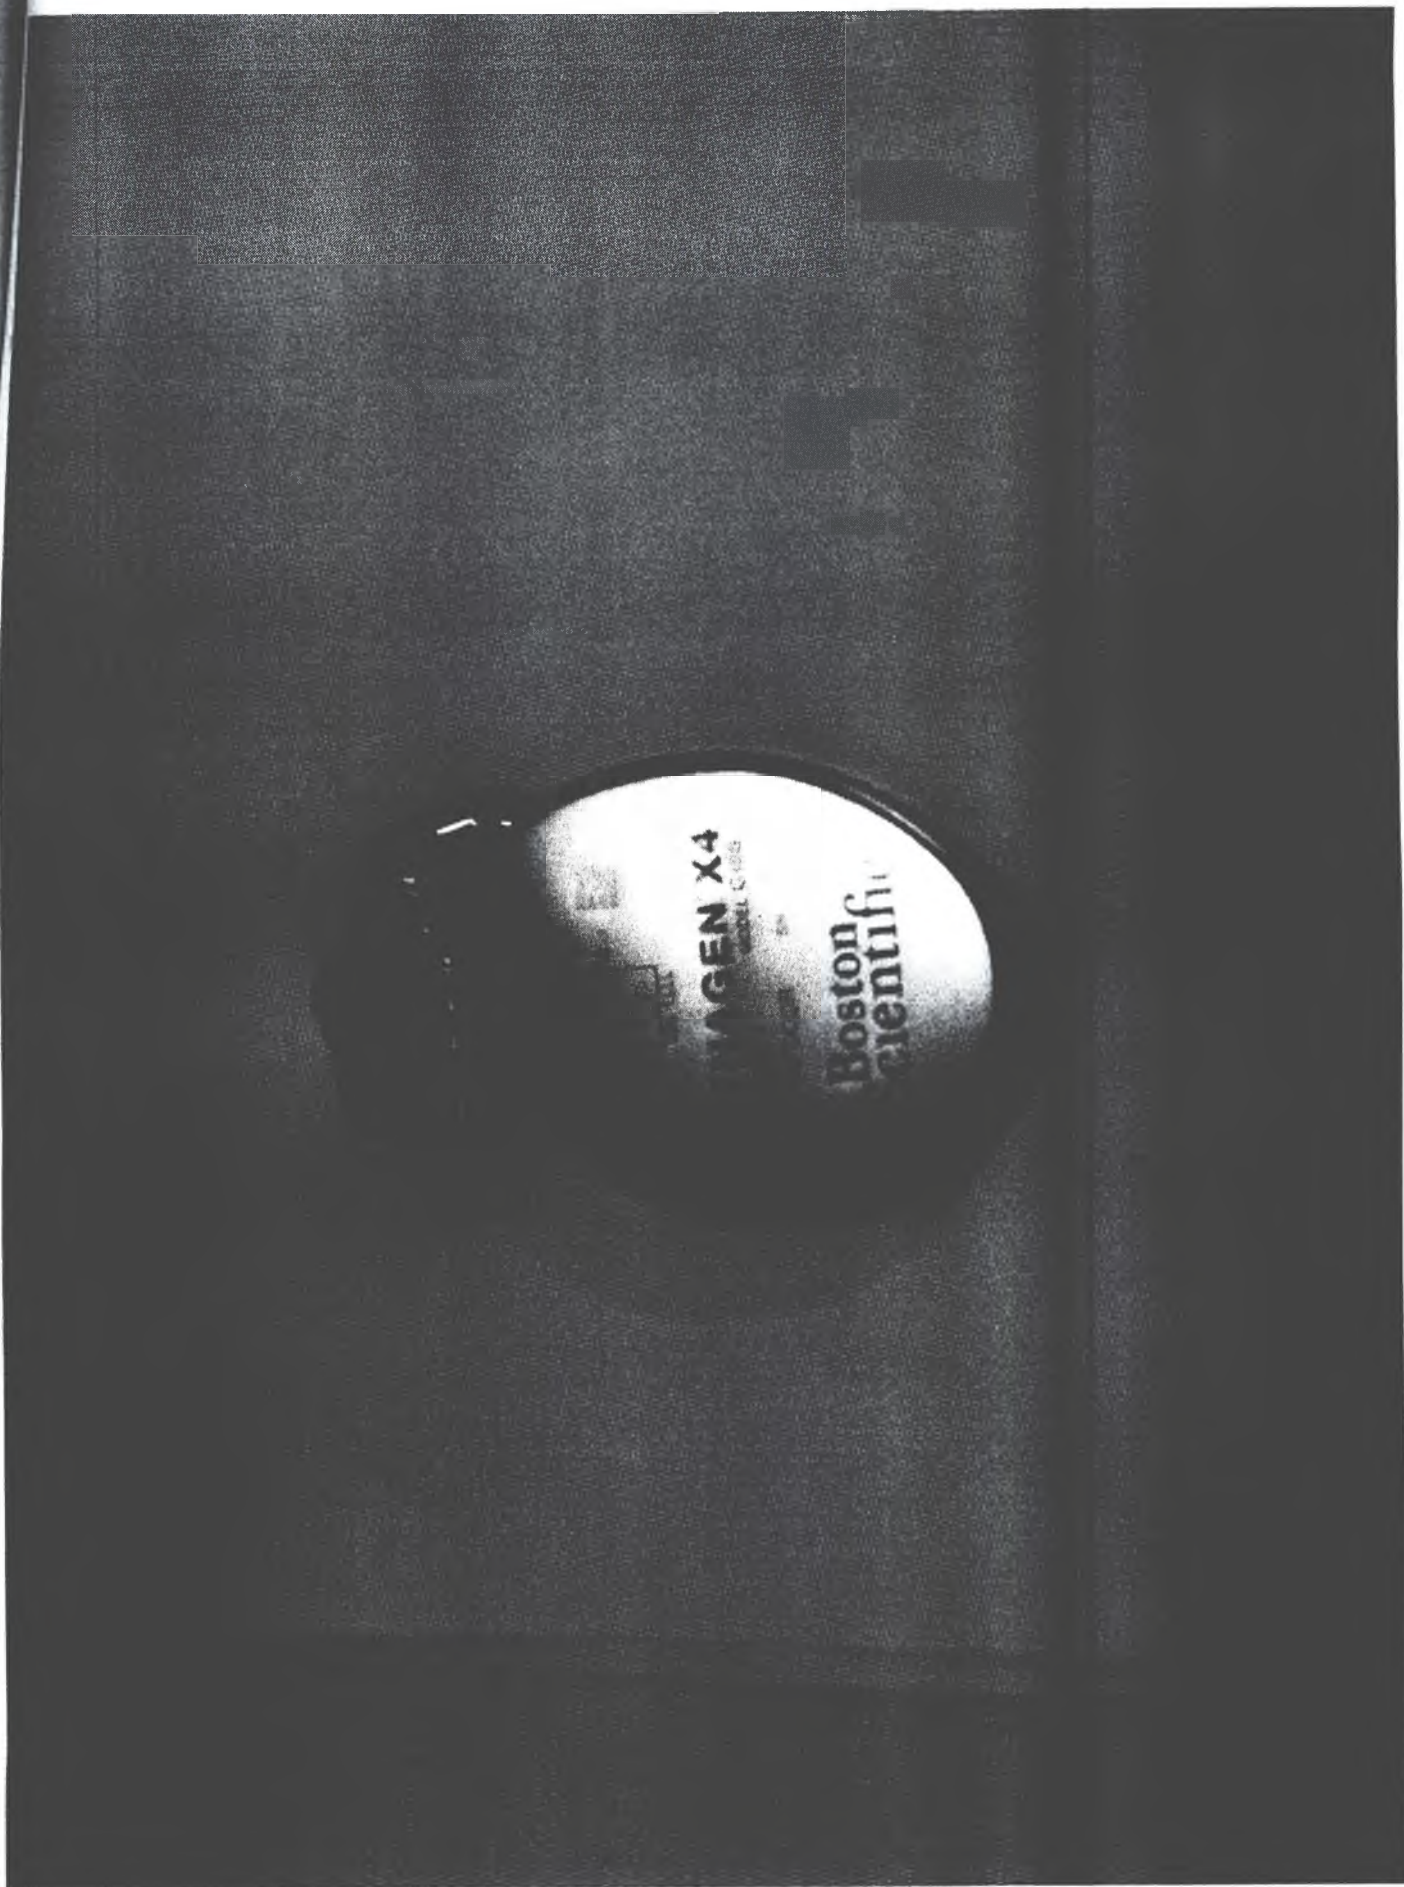


Фото 13. Кардиовертер-дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии на примере INOGEN X4 CRT-D модель G146, верх.

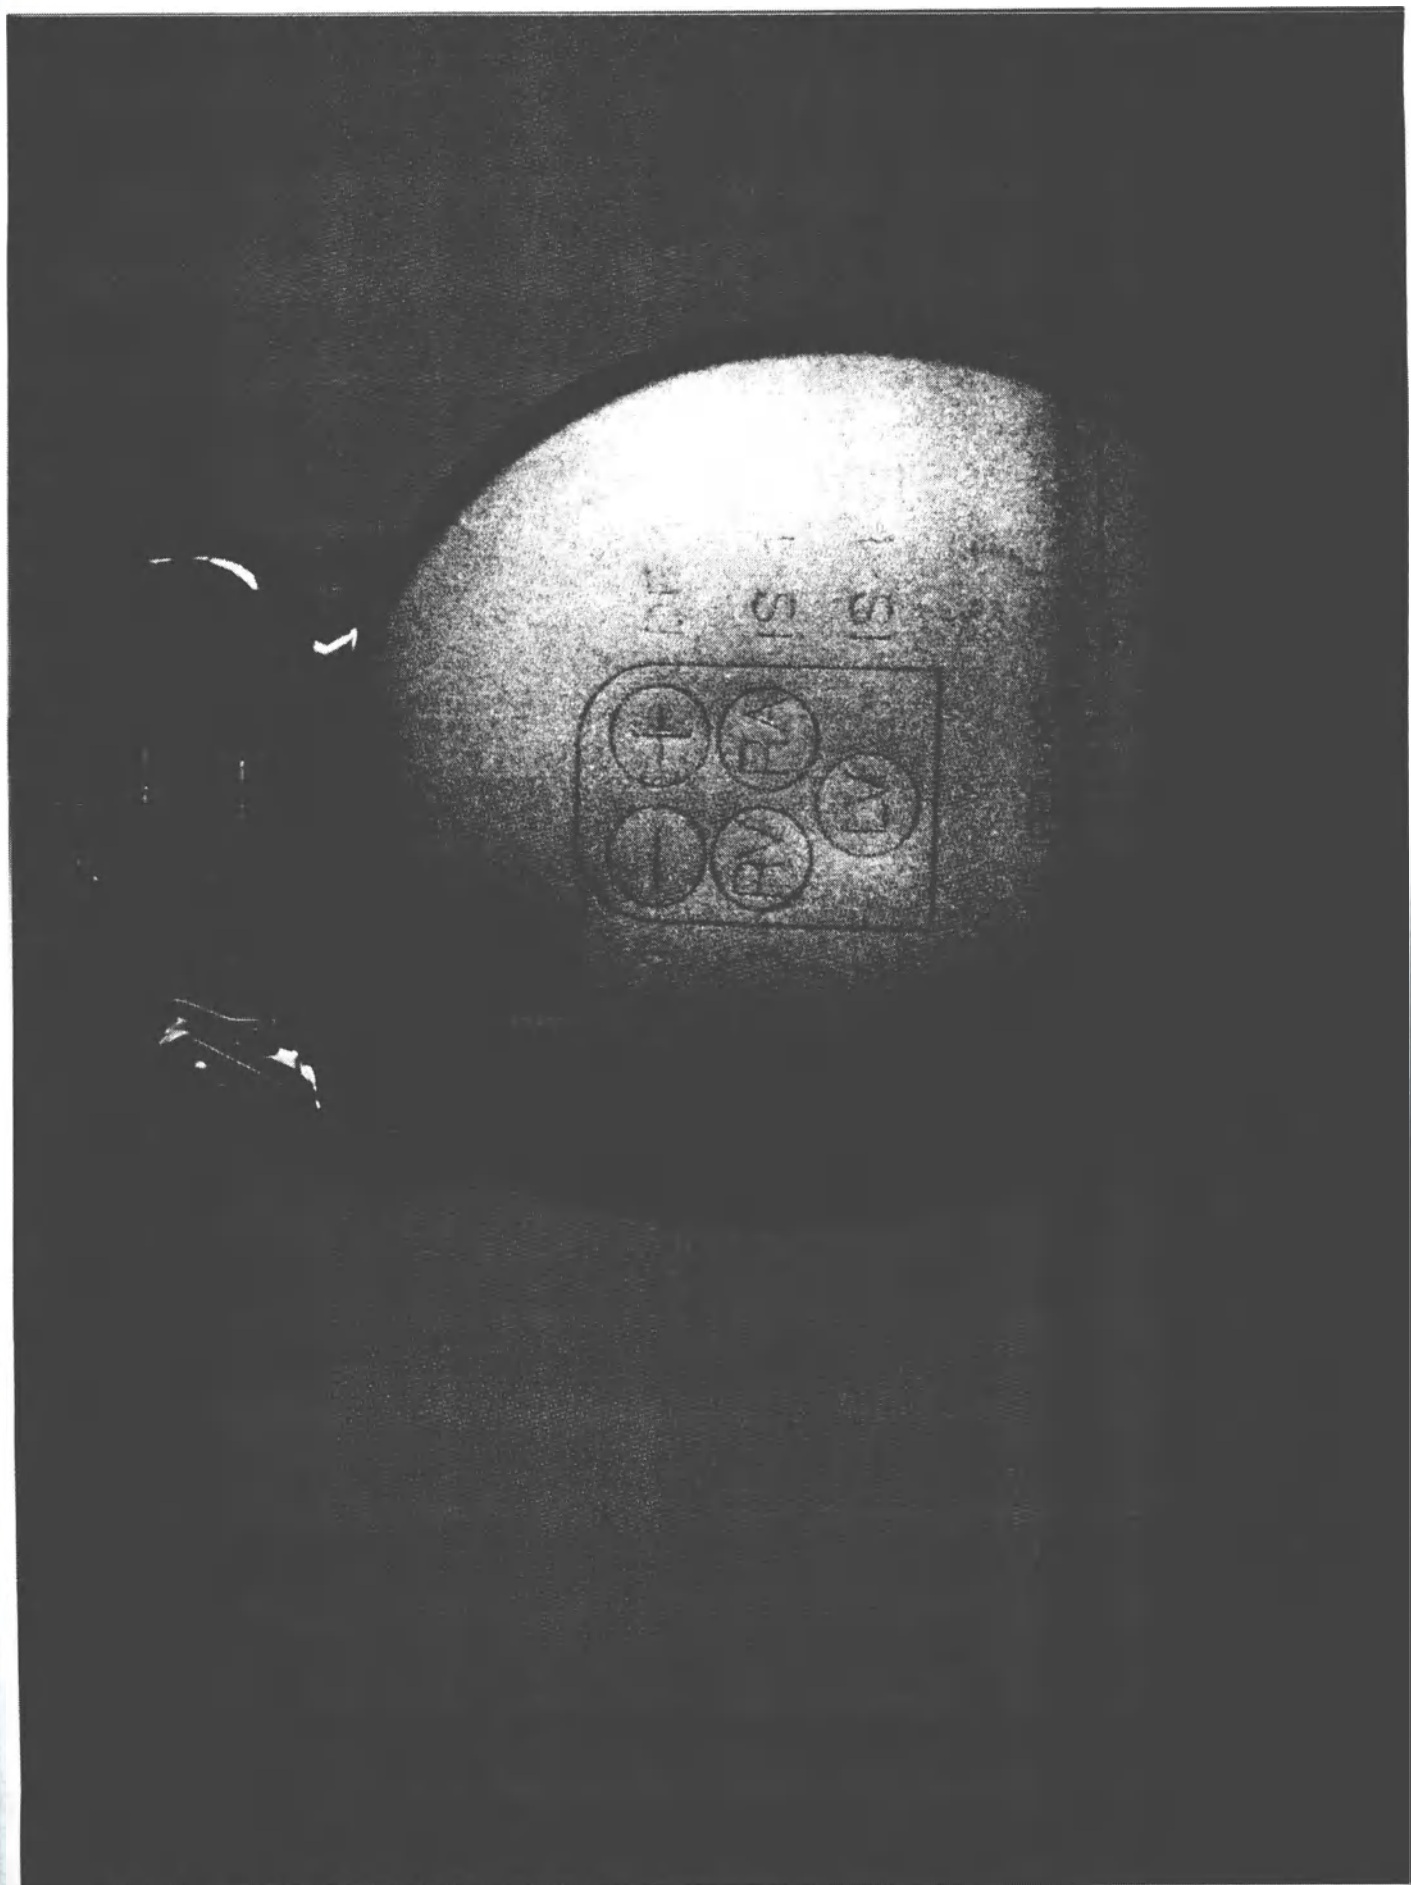


Фото 14. Кардиовертер-дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии на примере INOGEN X4 CRT-D модель G146, низ.

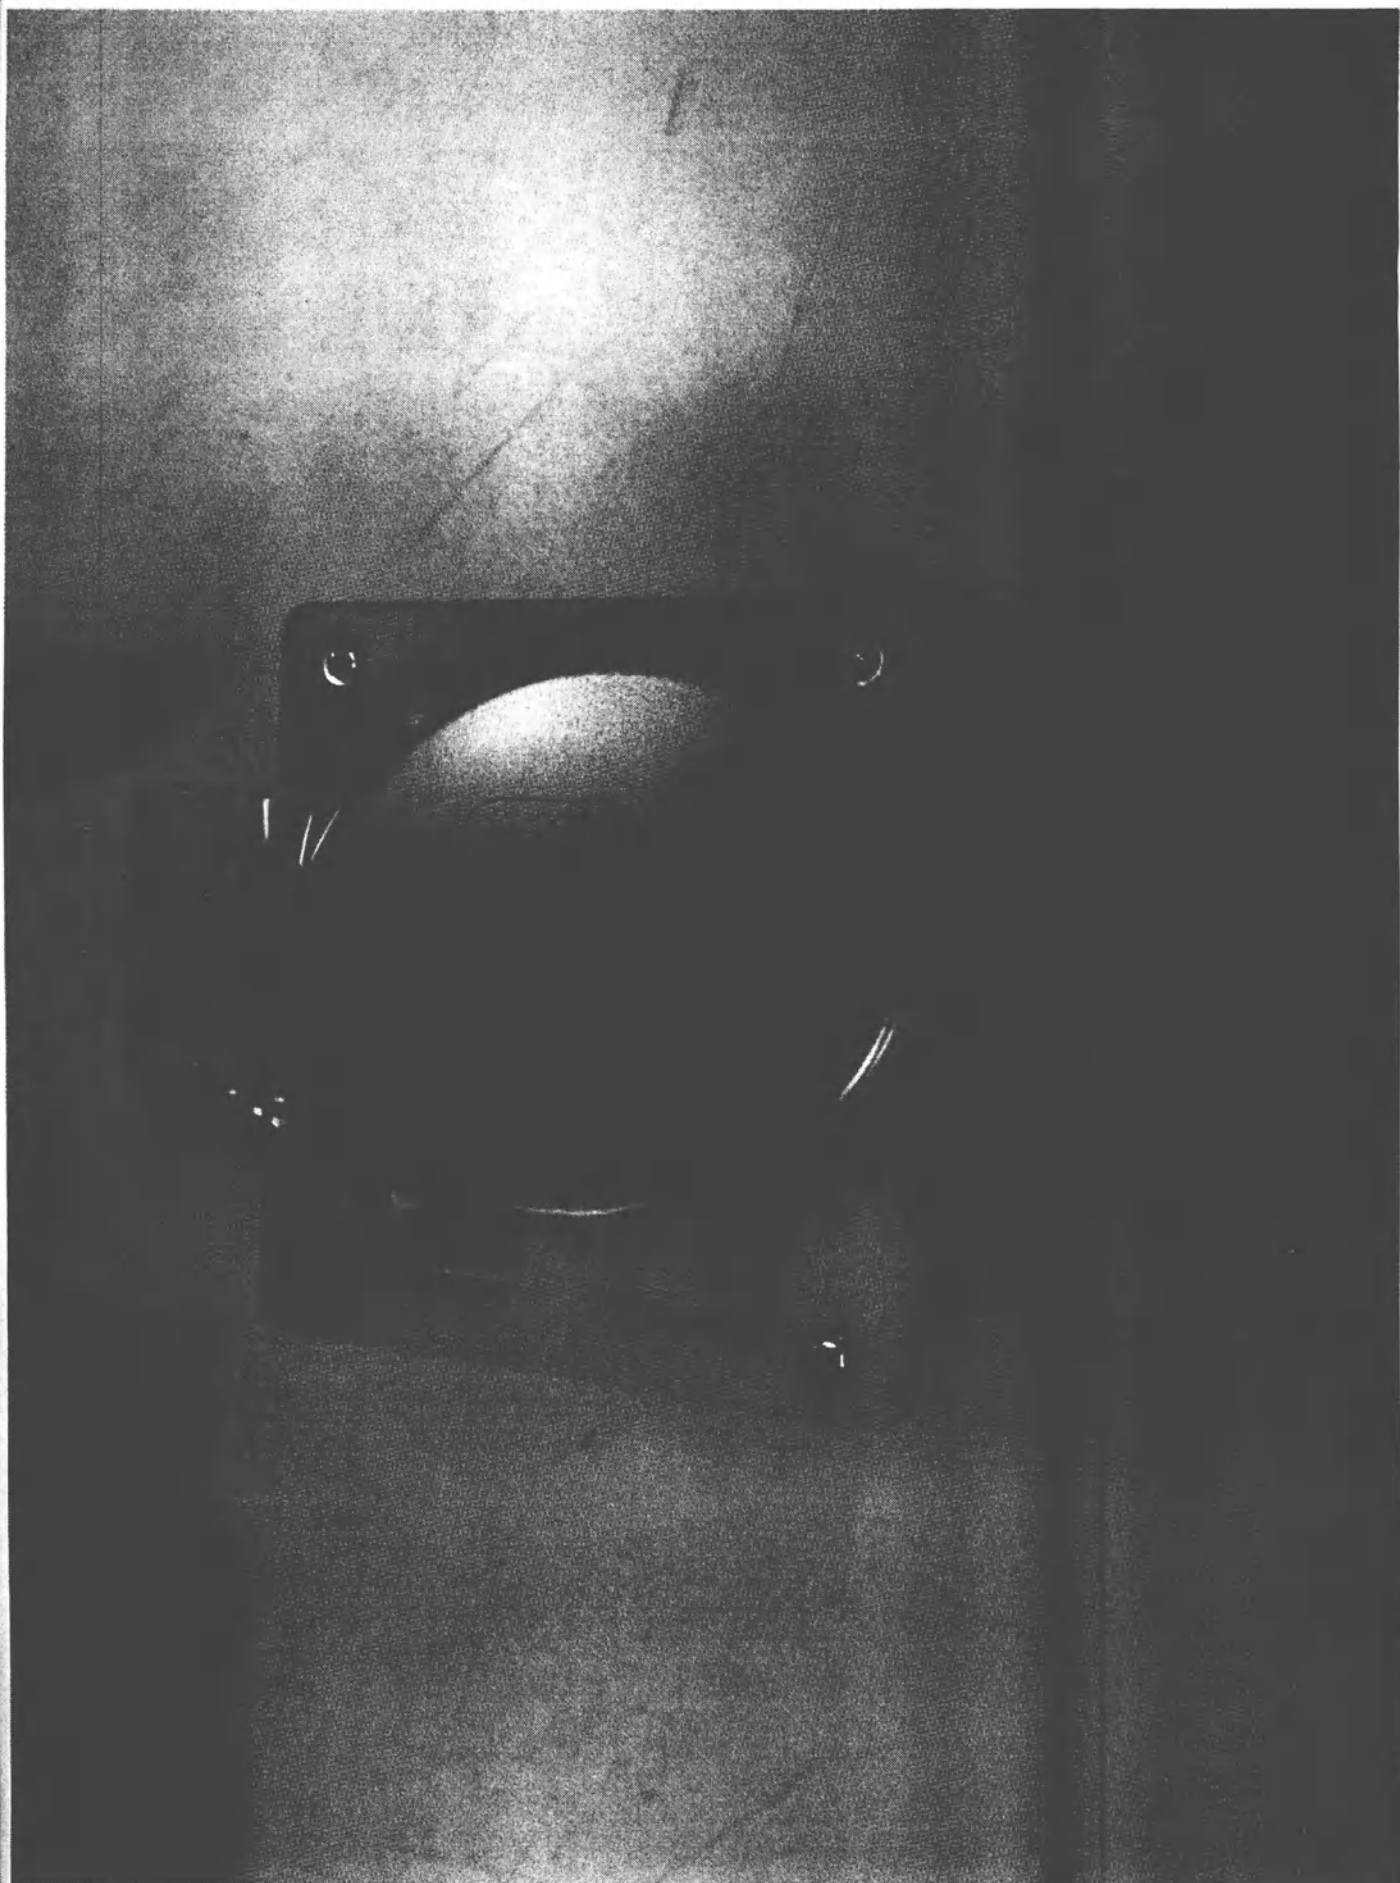


Фото 15. Кардиовертер-дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии на примере INOGEN X4 CRT-D (MRI) модель G179, низ.

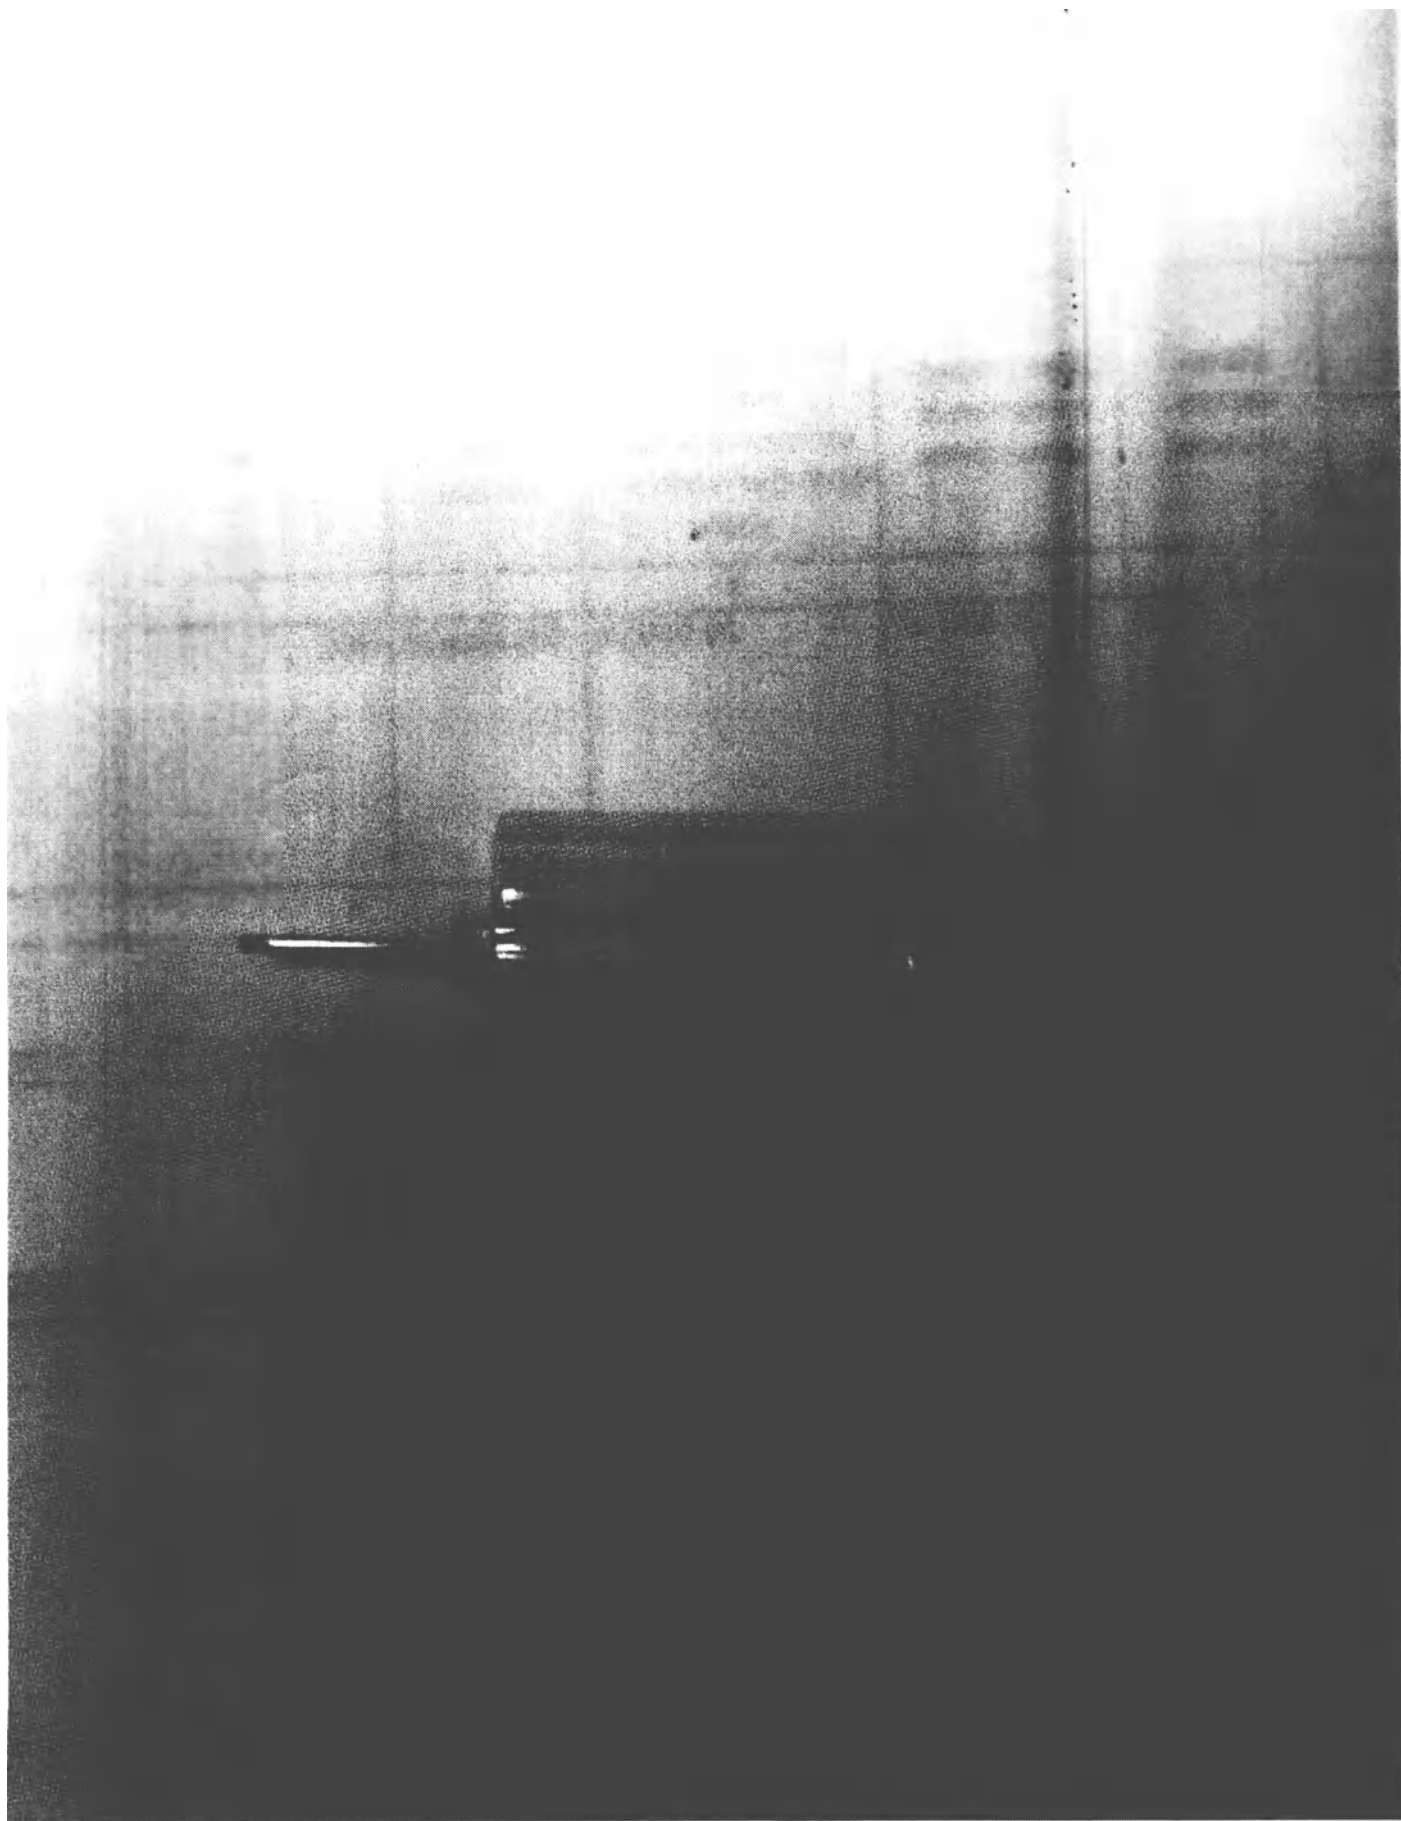


Фото 16. Отвертка, все варианты исполнения.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

7 лист(ов)

