


1. Электронный блок, ТЭСМ.556002, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



2. Электронный блок, ТЭСМ.516000, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

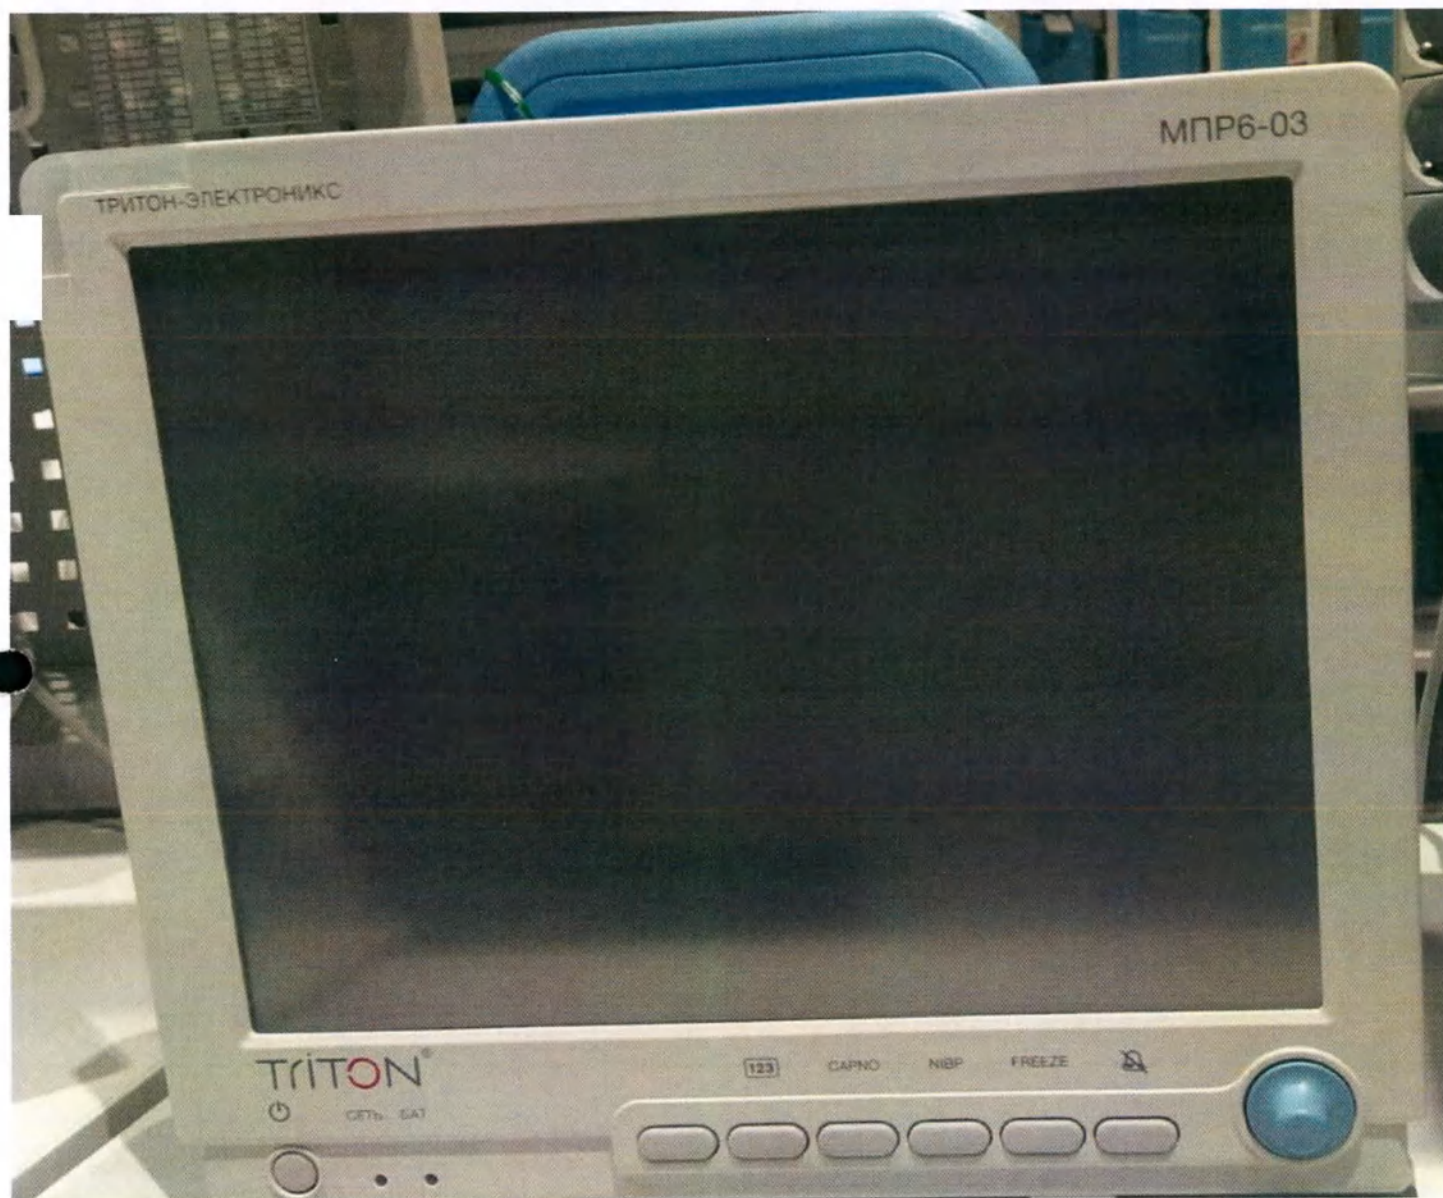


3. Кабель питания, ПВС-ВП 3х1,0 (3м, разъем питания С13), Производственная компания «Электрическая мануфактура», Россия.




4. Датчик CO₂ в прямом потоке, ТЭСМ.506138, из состава модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001



5. Вентиляционный адаптер взрослый/детский, ТЭСМ.706020, из состава модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001

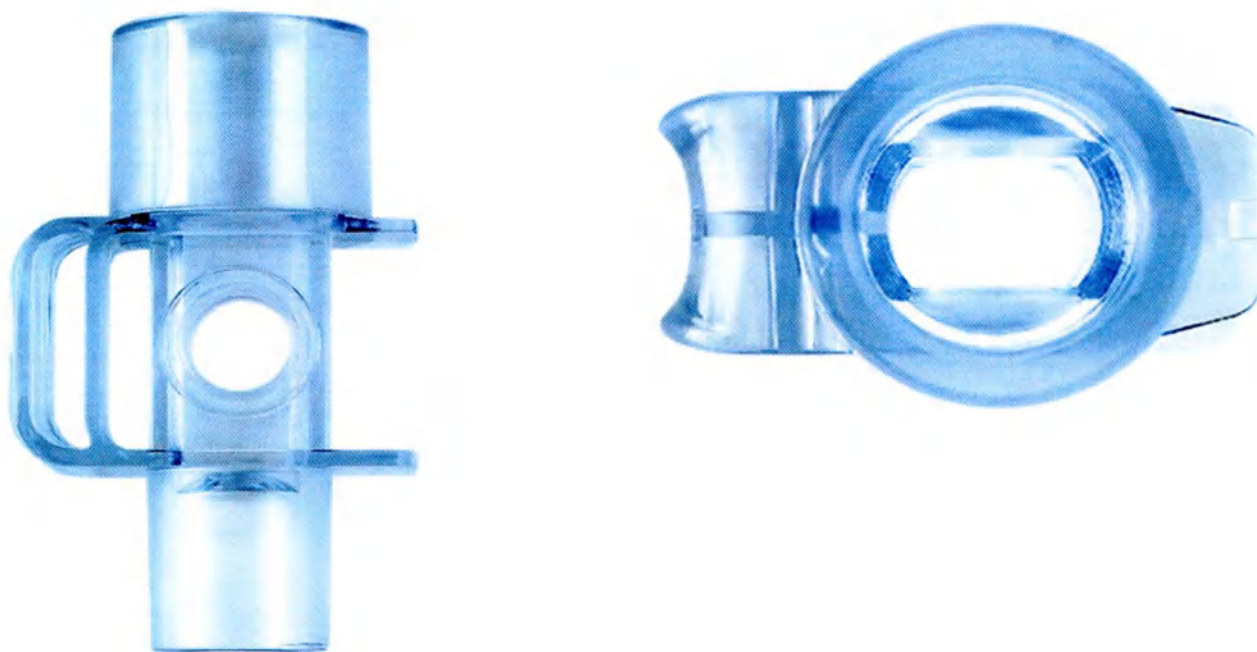

6. Вентиляционный адаптер детский/неонатальный, ТЭСМ.706021, из состава модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001

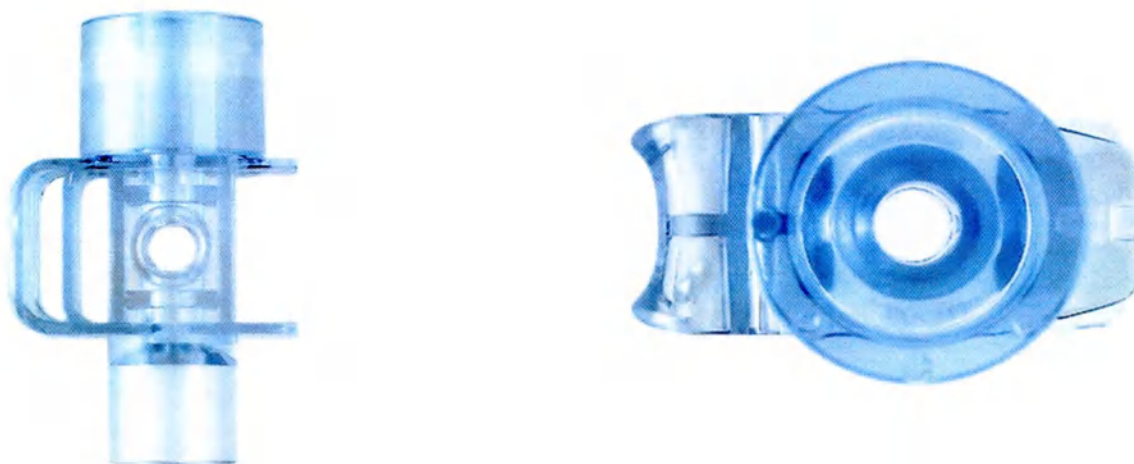


7. Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПП-"Тритон",
PM501.00.124-01, рег. удостоверение № ФСР 2011/11675,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.




8. Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-"Тритон",
PM501.00.004-01, рег. удостоверение № ФСР 2011/11675, ООО фирма «Тритон-
ЭлектроникС», Россия.




9. Датчик пульсоксиметрический педиатрический, клипса, ТЭСМ.096011,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

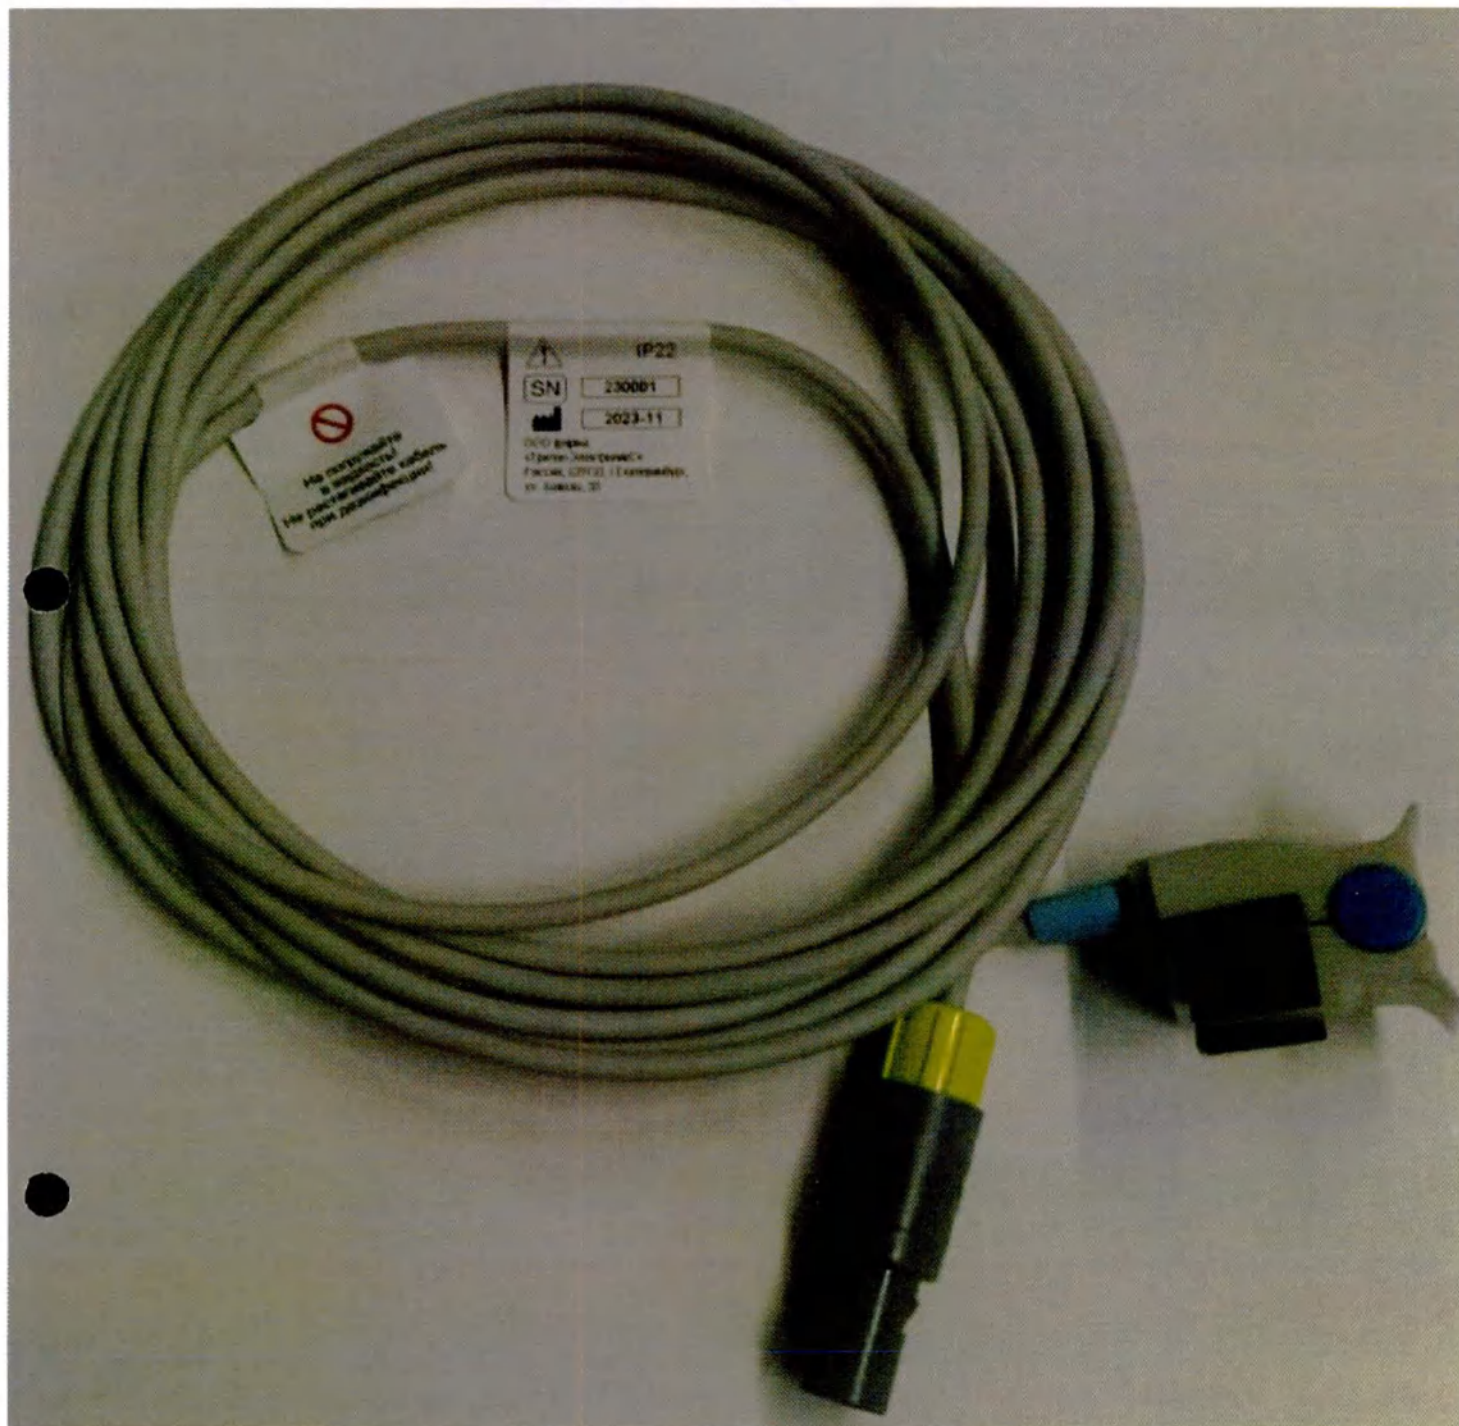

10. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, детский, самоклеящийся,
TECH.096021, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

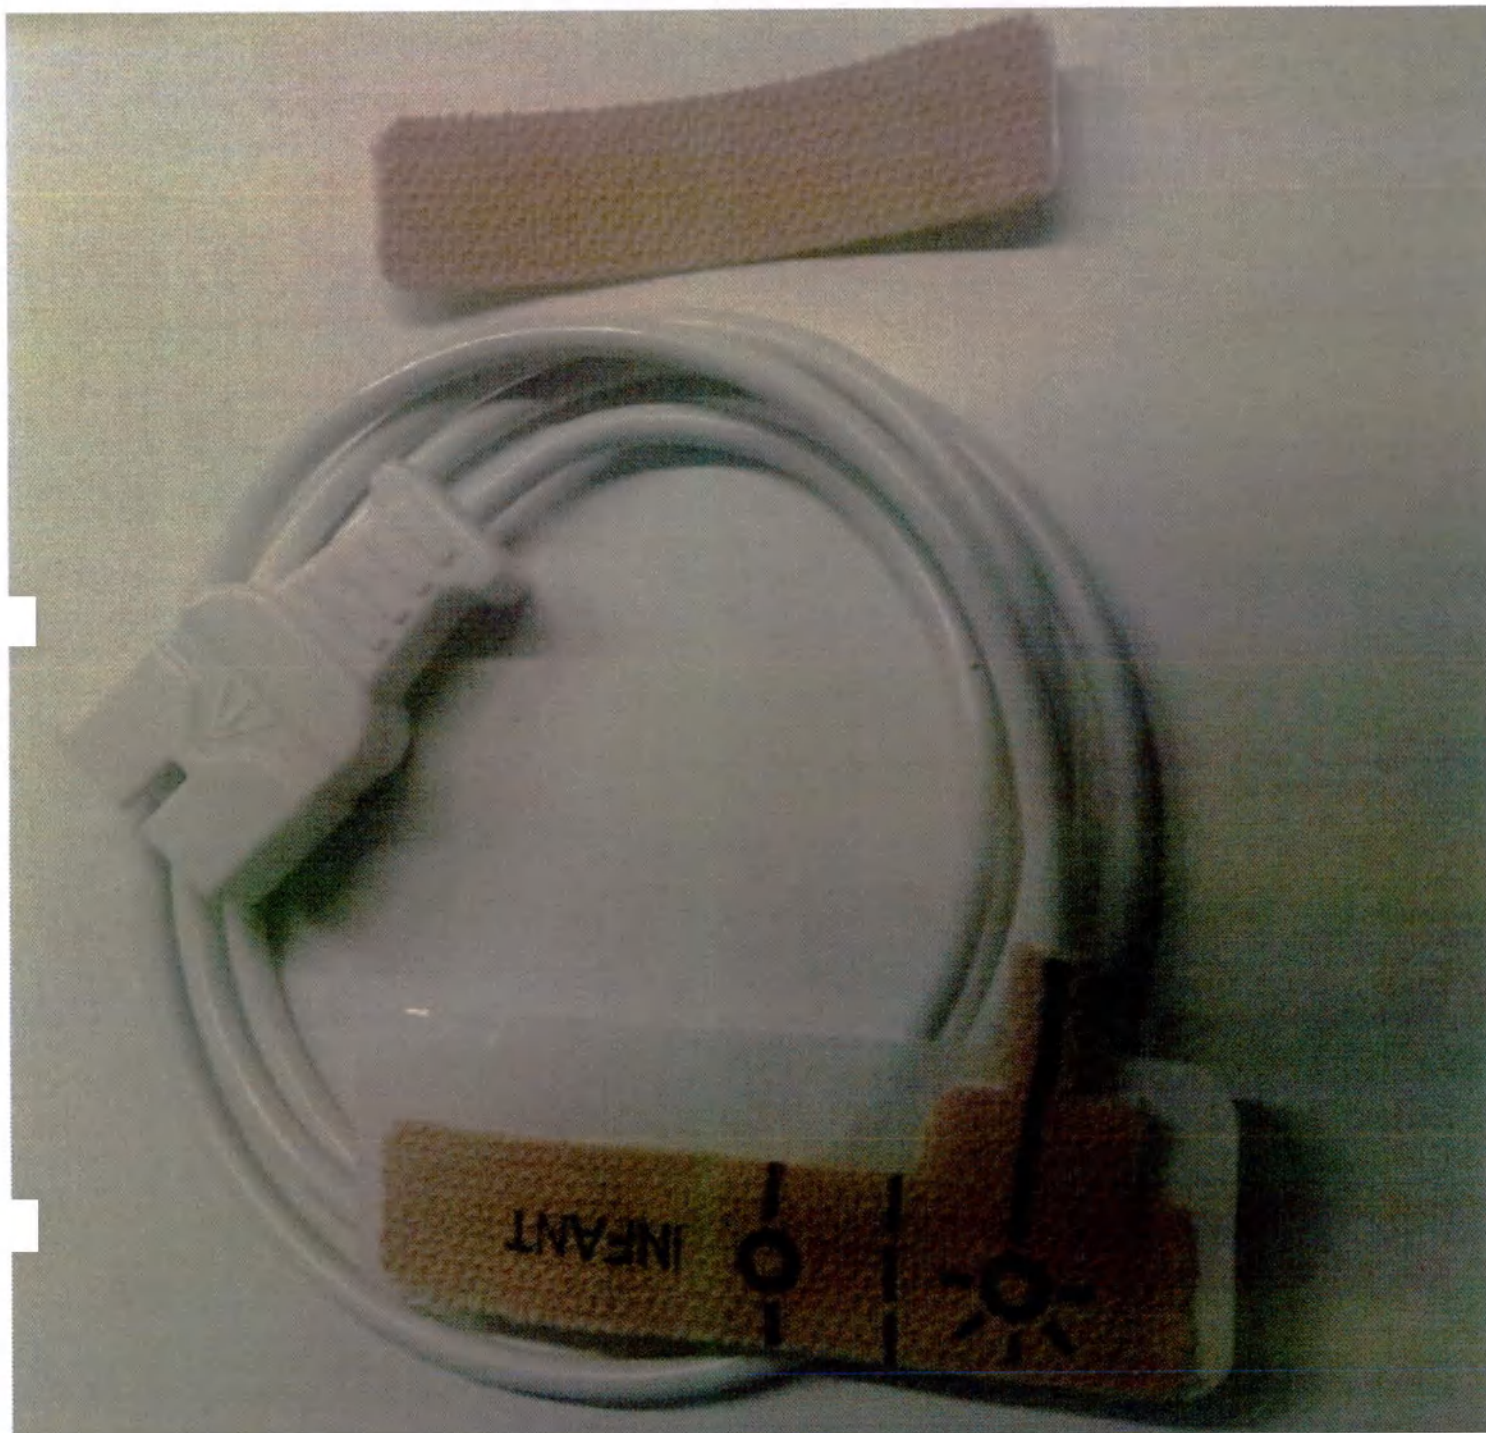


11. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, детский, самоклеящийся,
TECH.096021-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

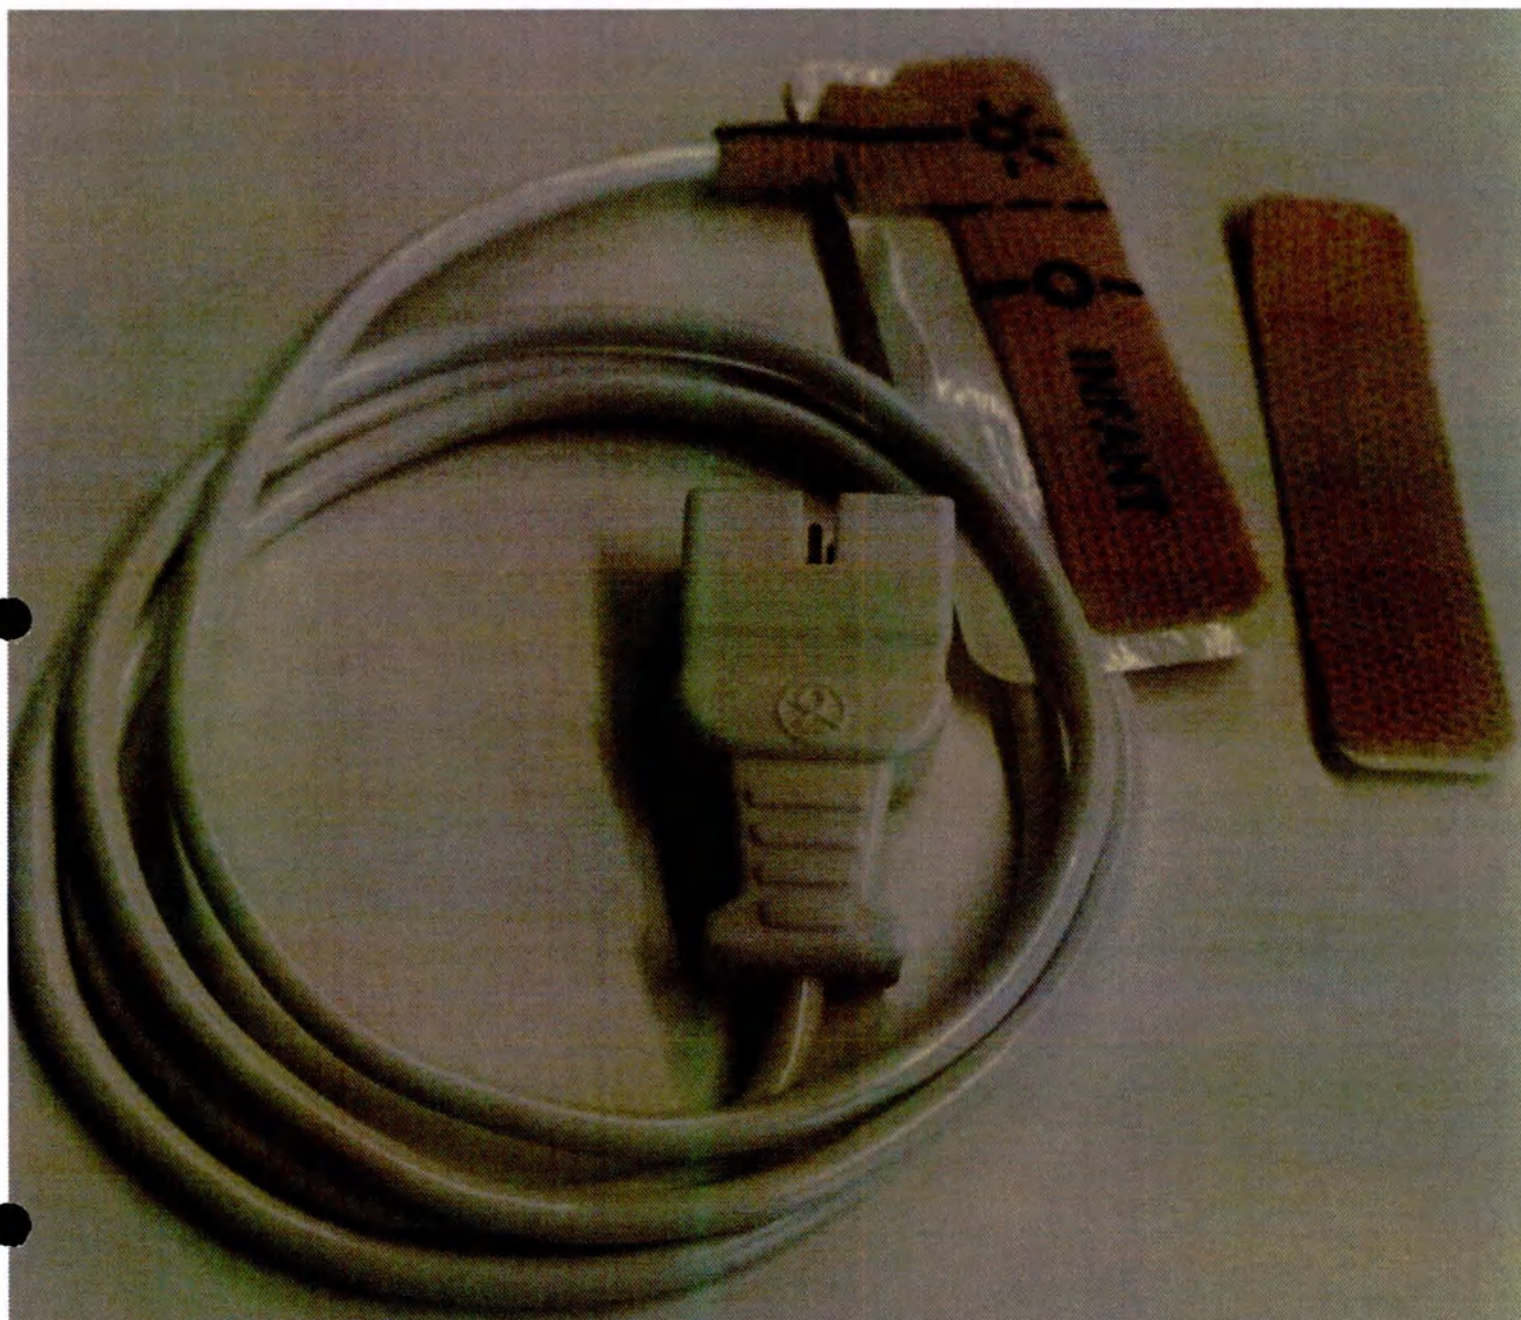


12. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, самоклеящийся, ТЕСН.096022,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия


11

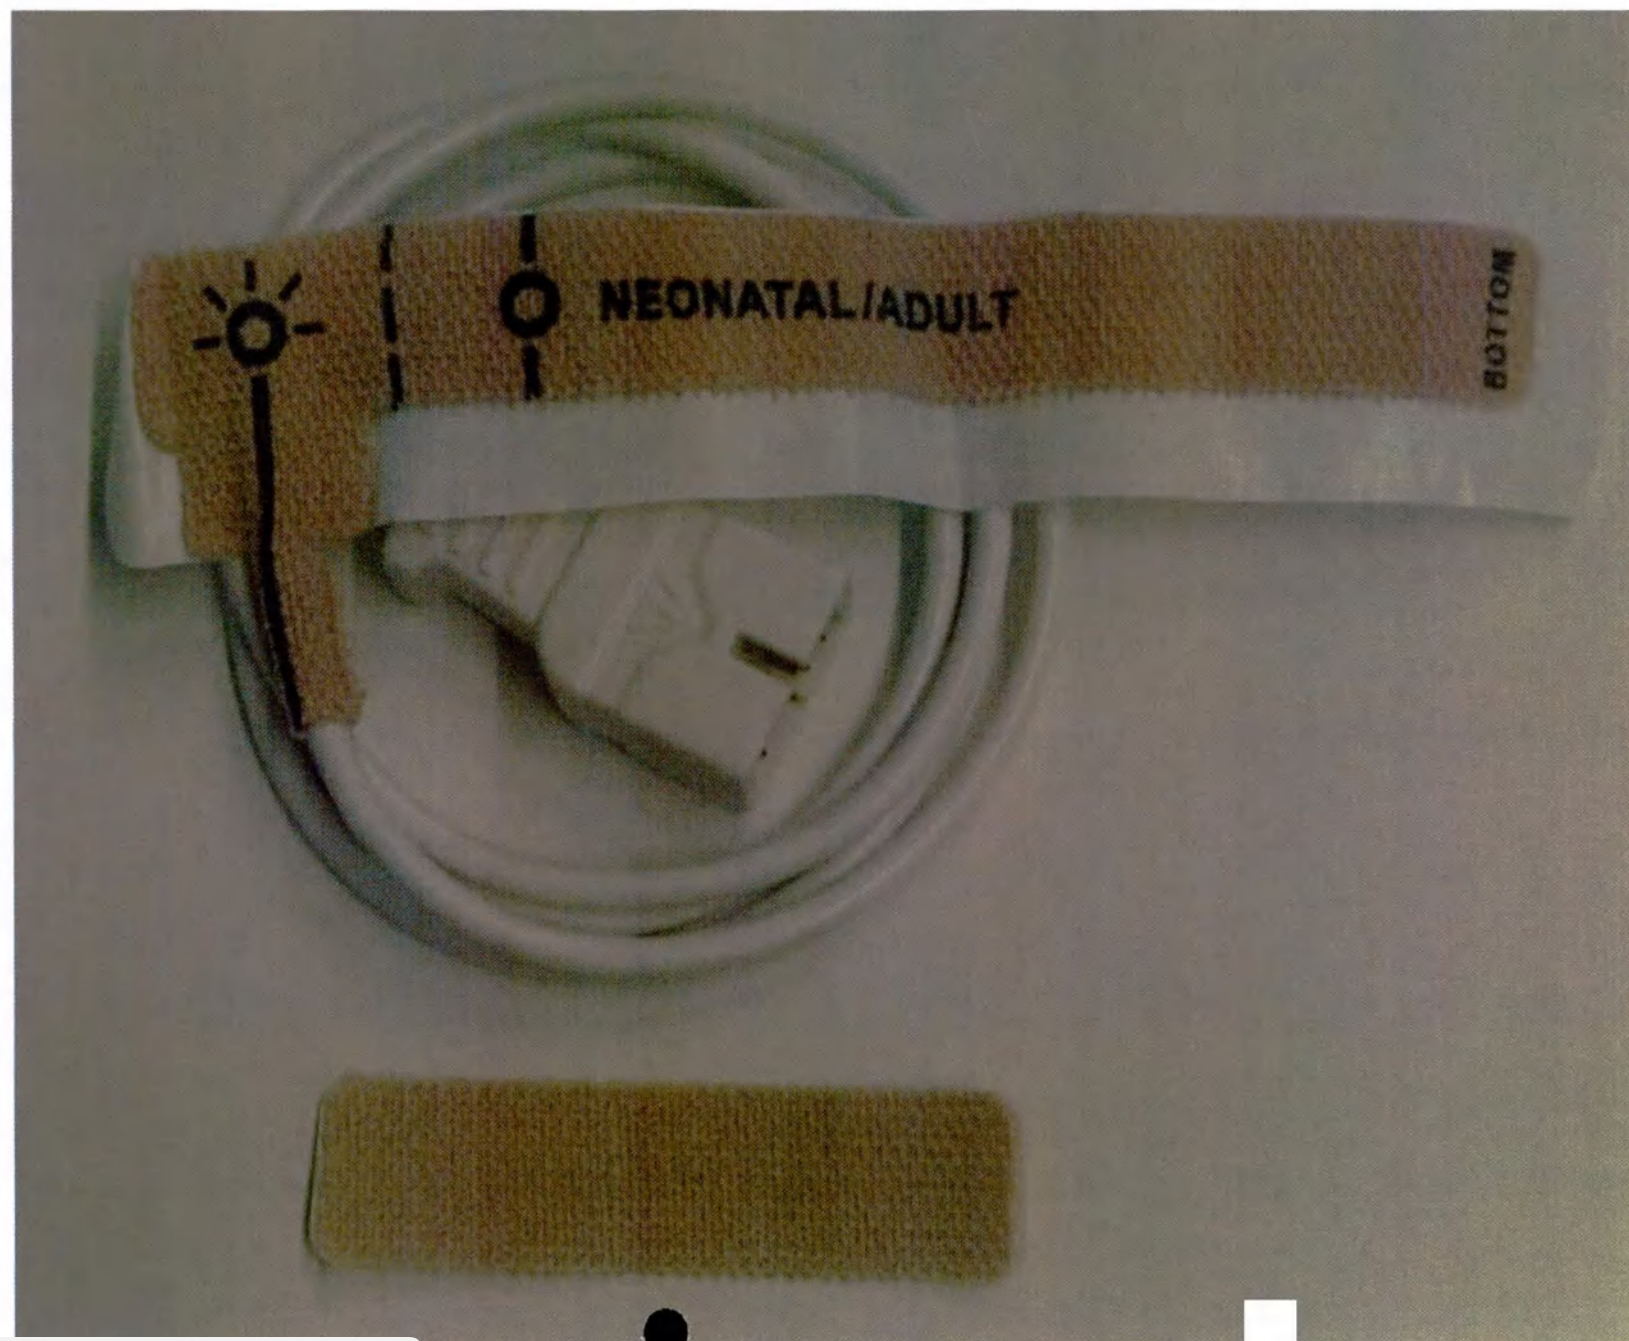


13. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, самоклеящийся, ТЕСН.096022-01,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

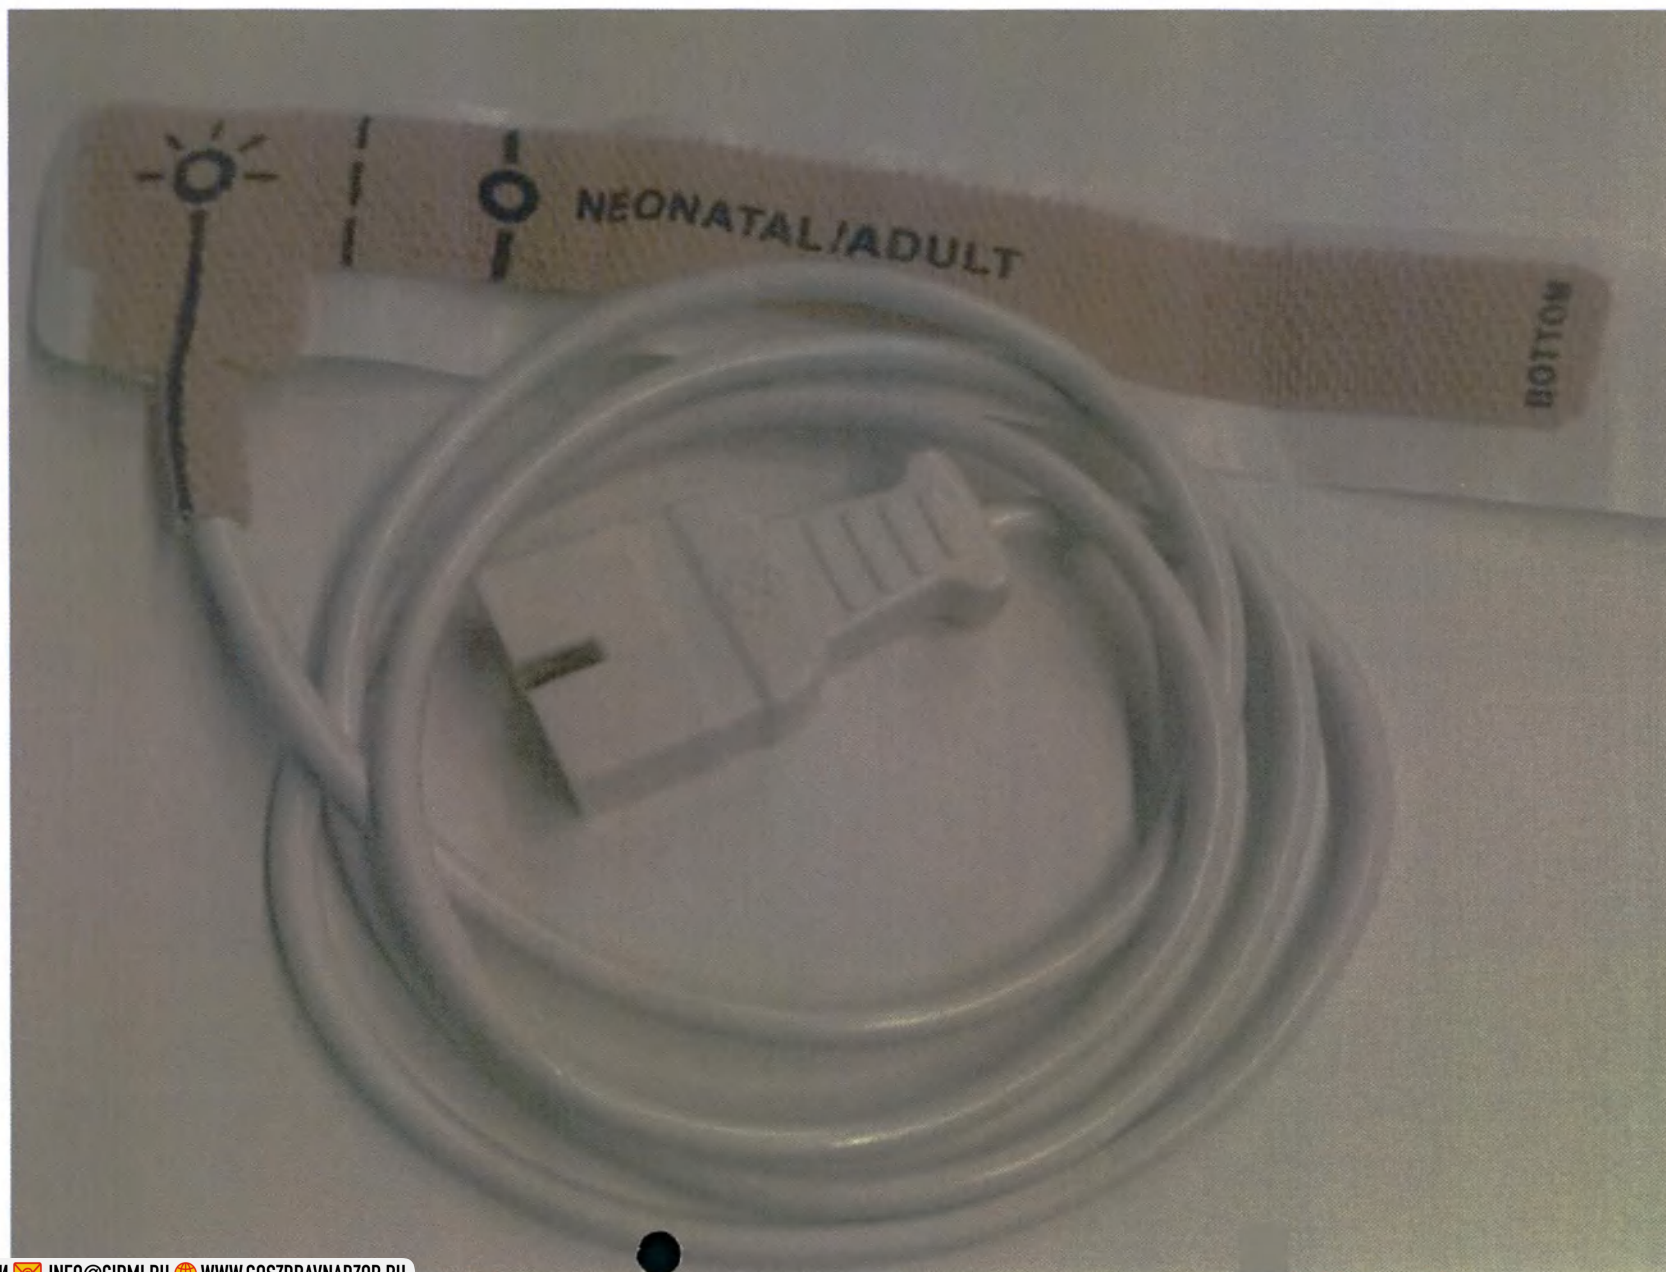

14. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, текстильная застежка, ТЕСН.096027,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

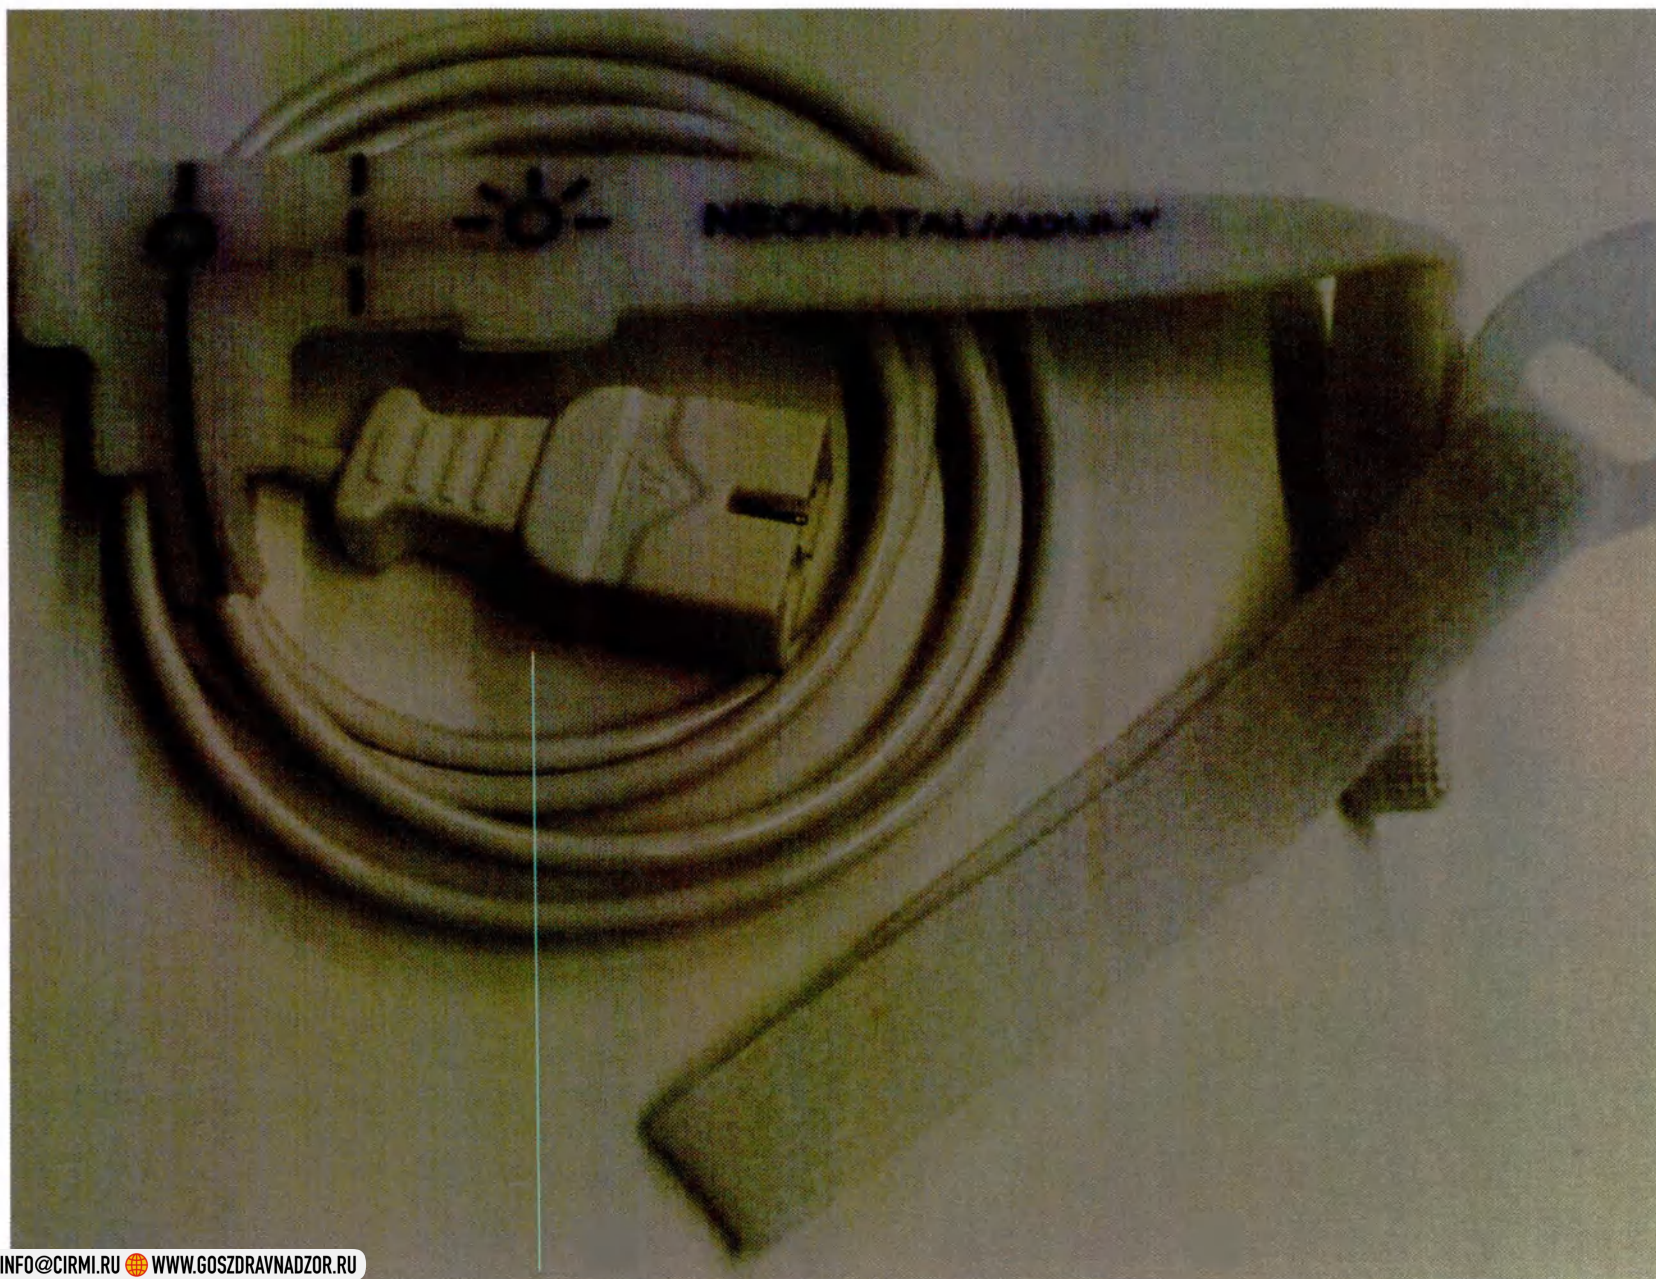

15. Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, текстильная застежка, ТЕСН.096027-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

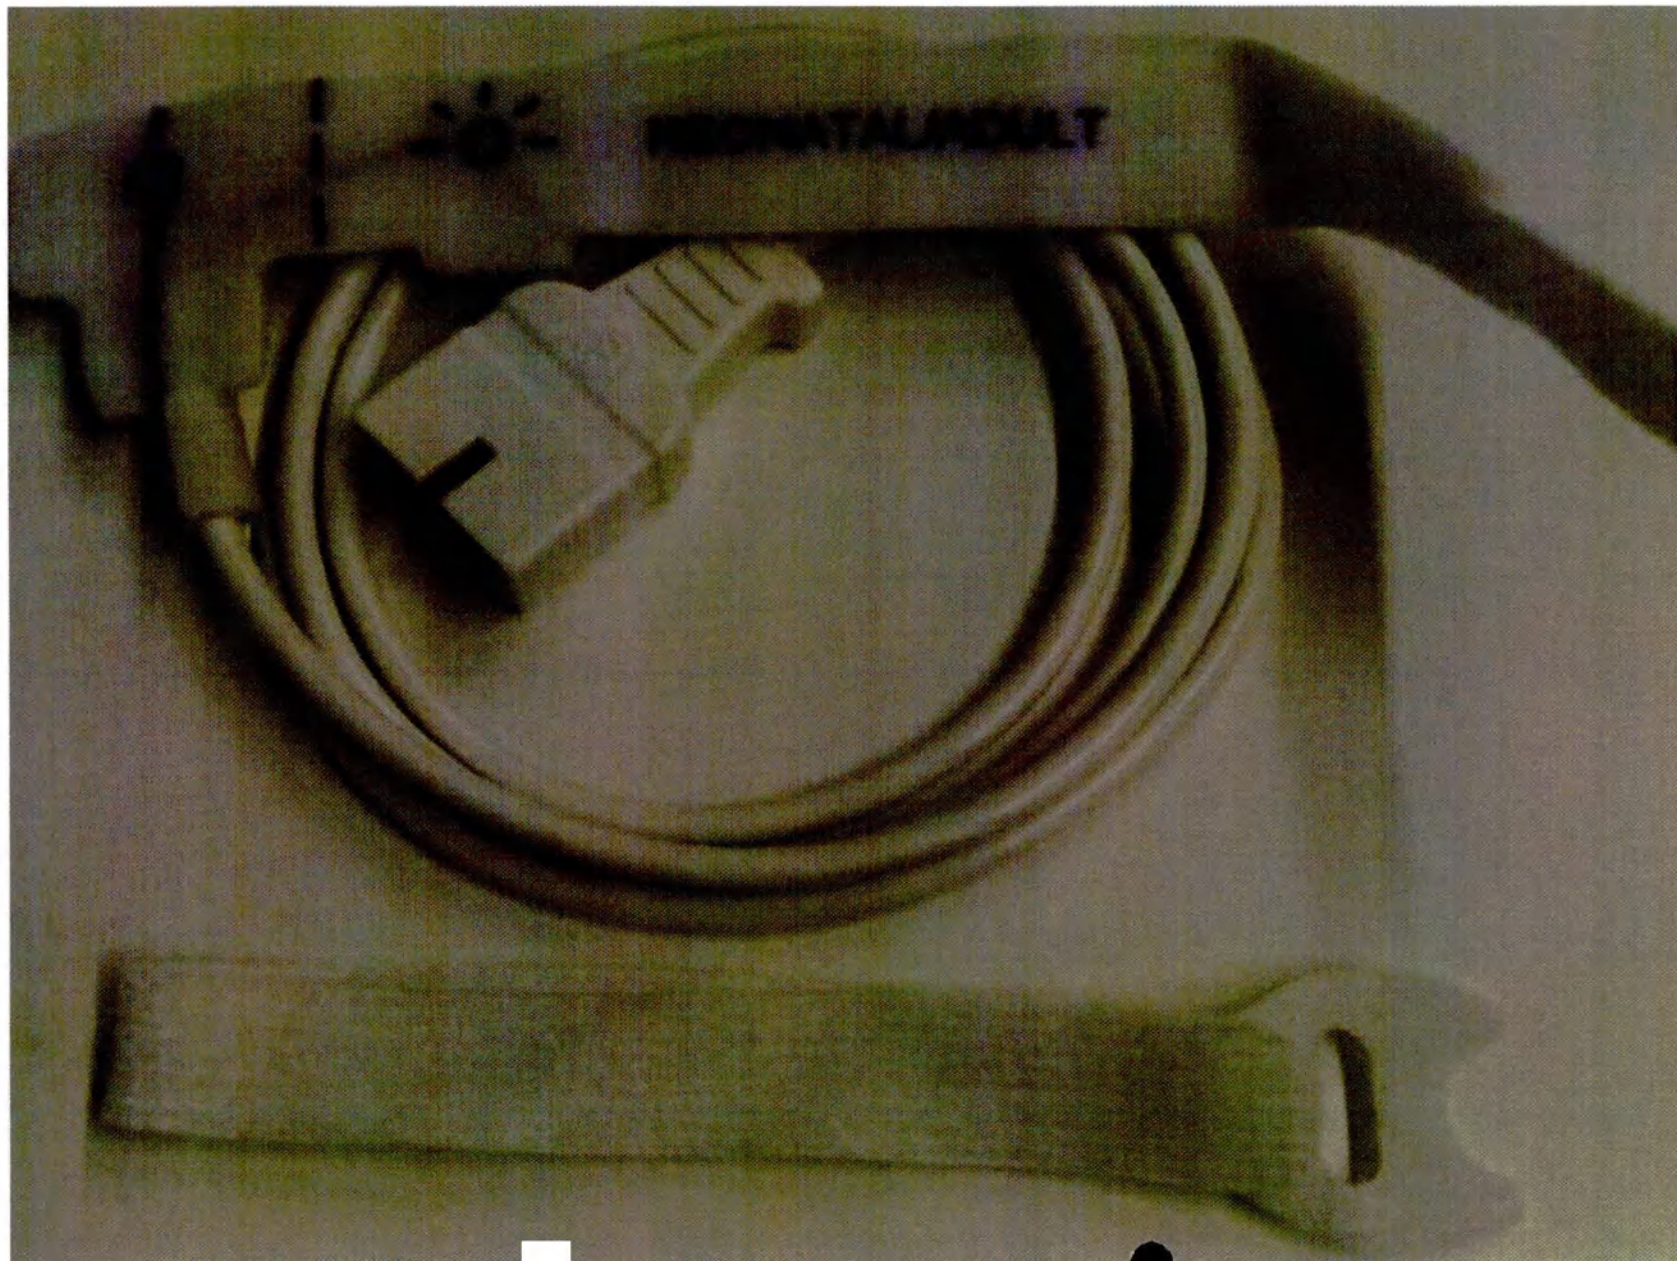

16. Переходник датчика пульсоксиметрического, ТЭСМ.534014-01,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



17. Кабель пациента, РМ501.00.120-03,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




18. Кабель пациента, РМ501.00.120-04, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




19. Кабель пациента, PM501.00.120-05, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия



20. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики, WhiteSensor 40713,
рег. удостоверение №ФСЗ 2008/02776, Ambu A/S, Дания

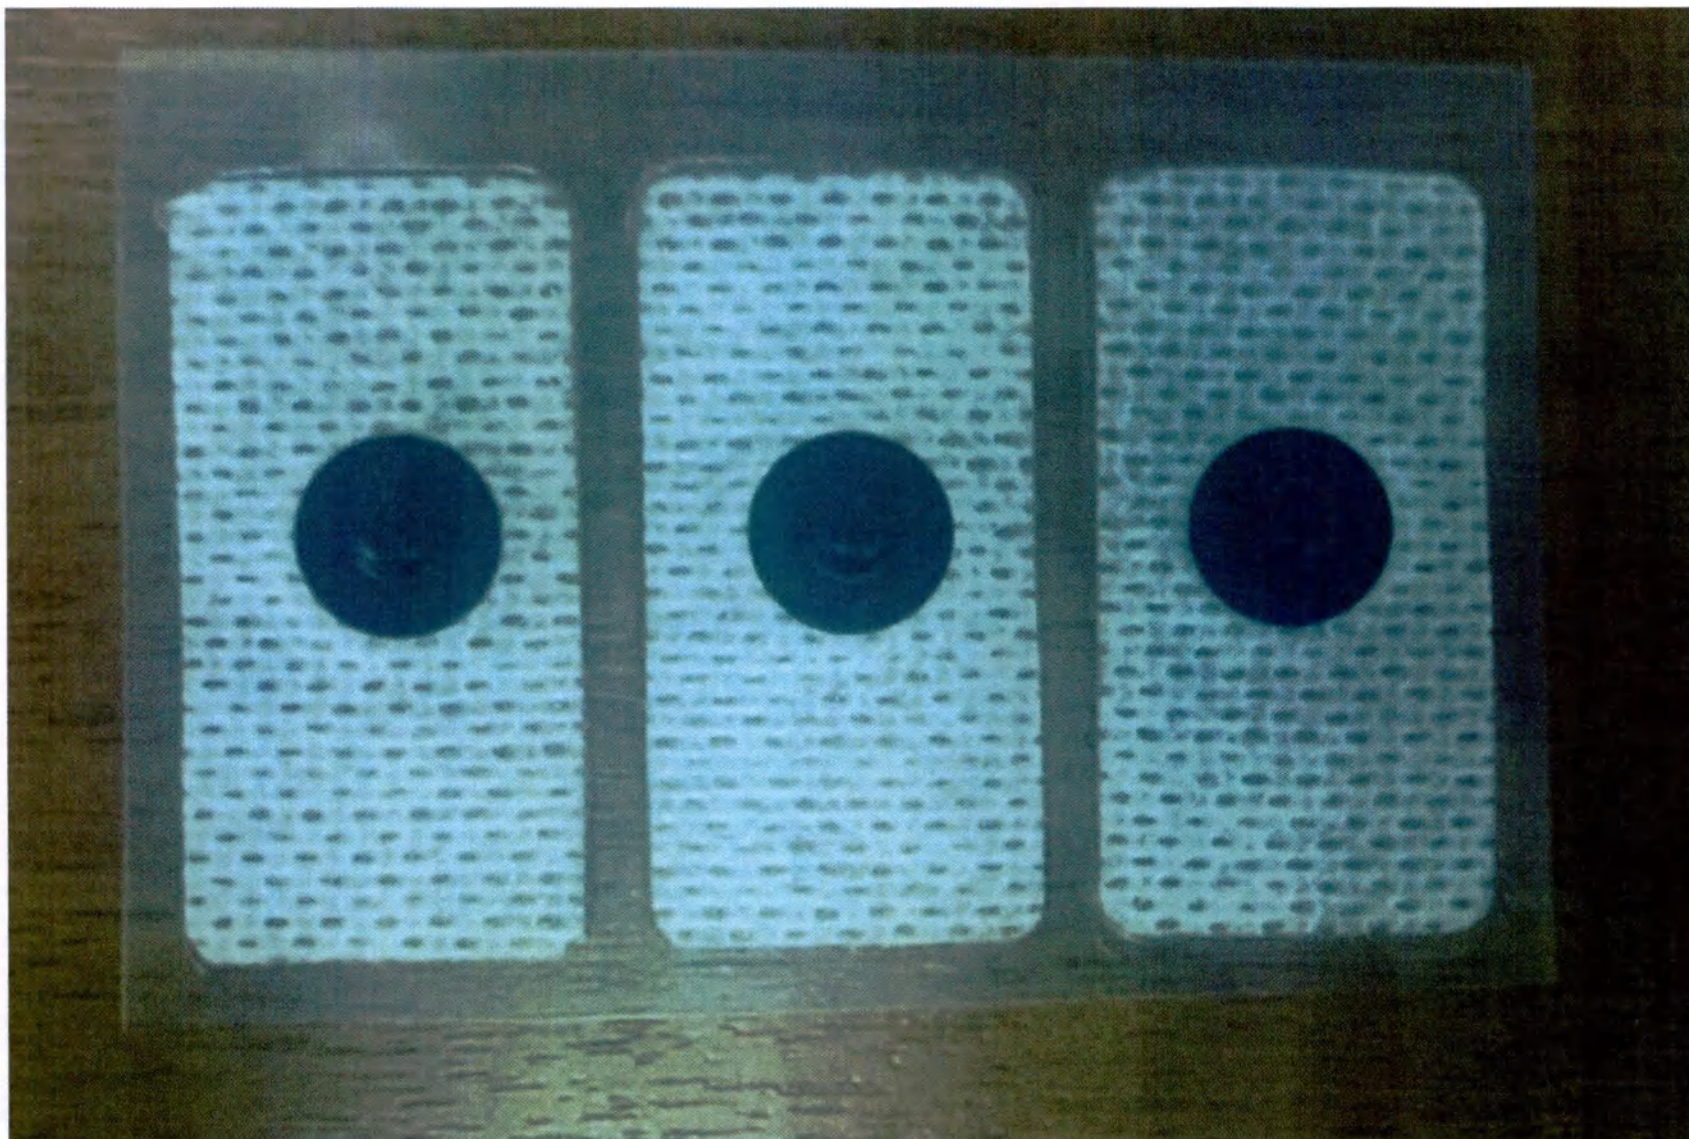

21. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов), WhiteSensor 40554, рег. удостоверение №ФСЗ 2008/02776, Ambu A/S, Дания.

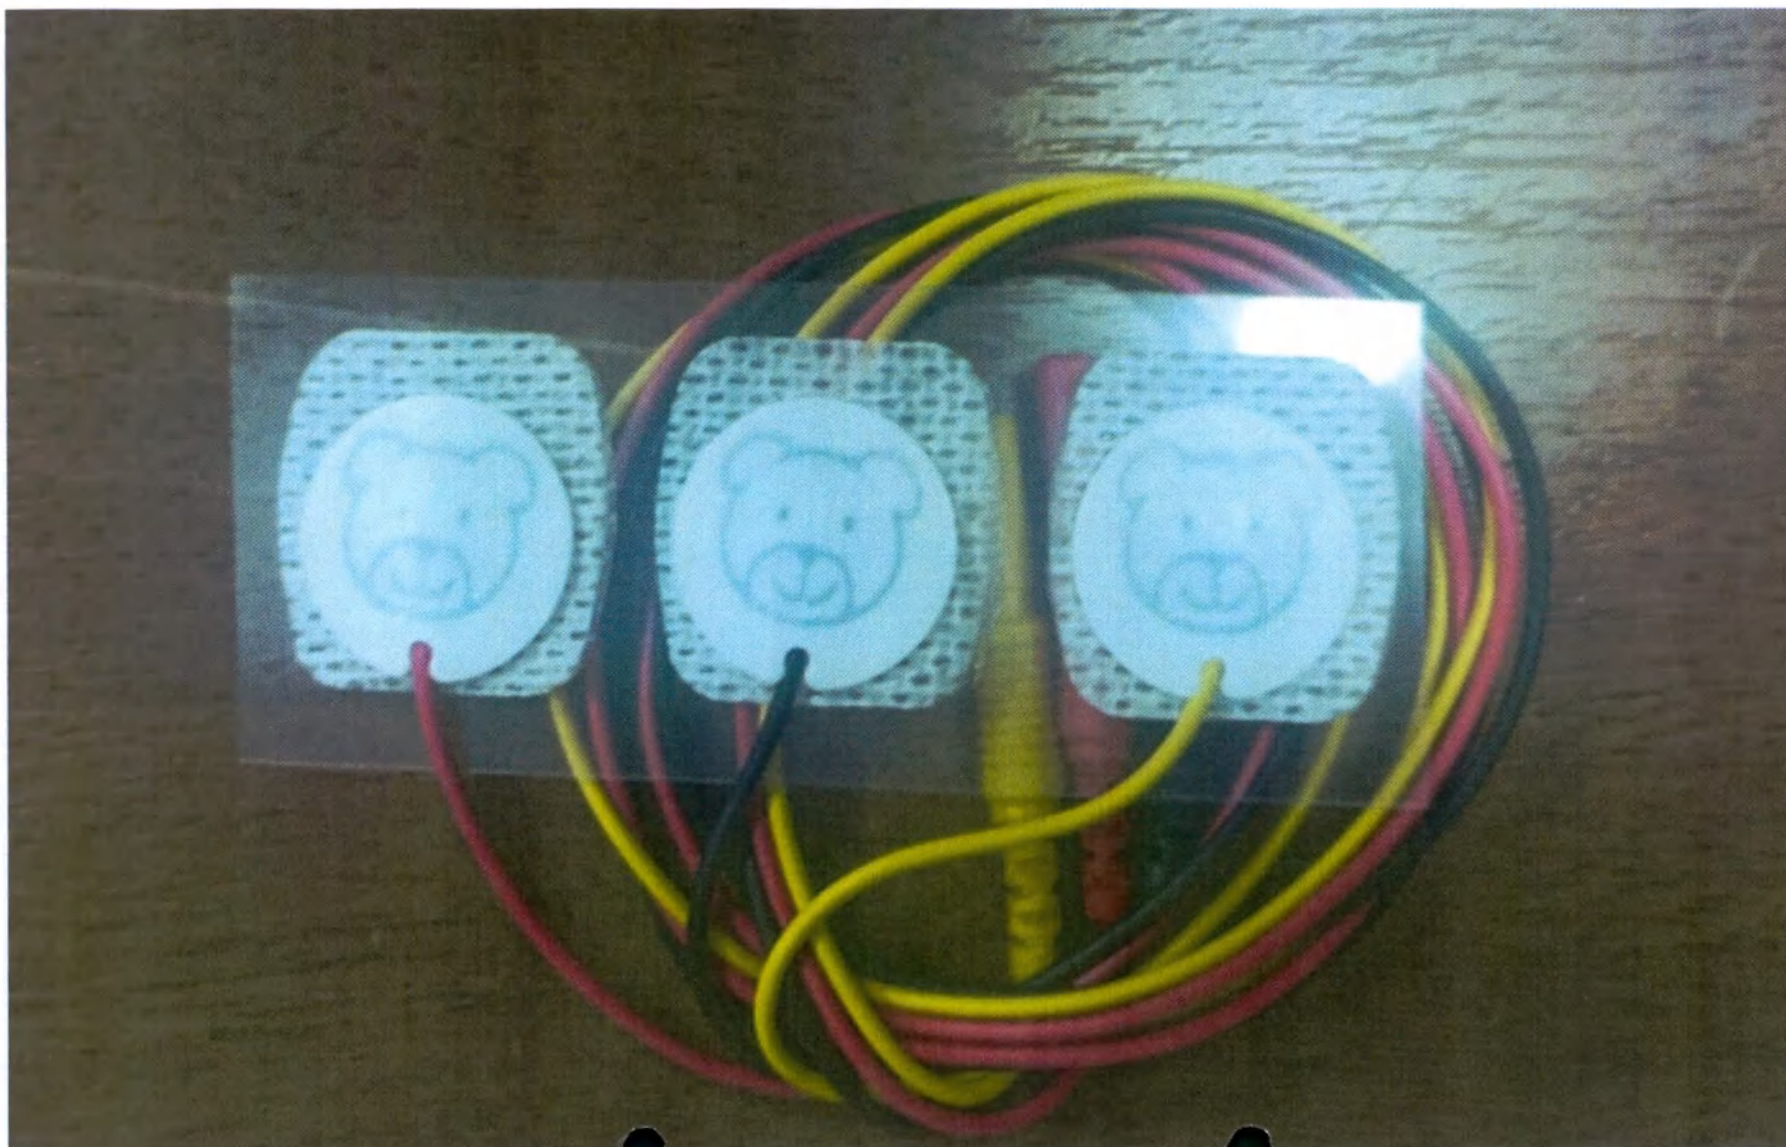

22. Электроды для электрокардиографии Ambu® WhiteSensor одноразовые с твердым гелем, WS-00-S/RT/50,
рег. удостоверение №РЗН 2022/17335, Medico Electrodes Internation Ltd., Индия

21




23. Электроды для электрокардиографии Ambu® WhiteSensor одноразовые с жидким гелем 4570M, рег. удостоверение № РЗН 2022/17335, Medico Electrodes Internation Ltd., Индия




24. Электроды для ЭКГ, F9079/RU4345,
рег. удостоверение № ФСЗ 2010/07536, FIAB SpA, Италия

23

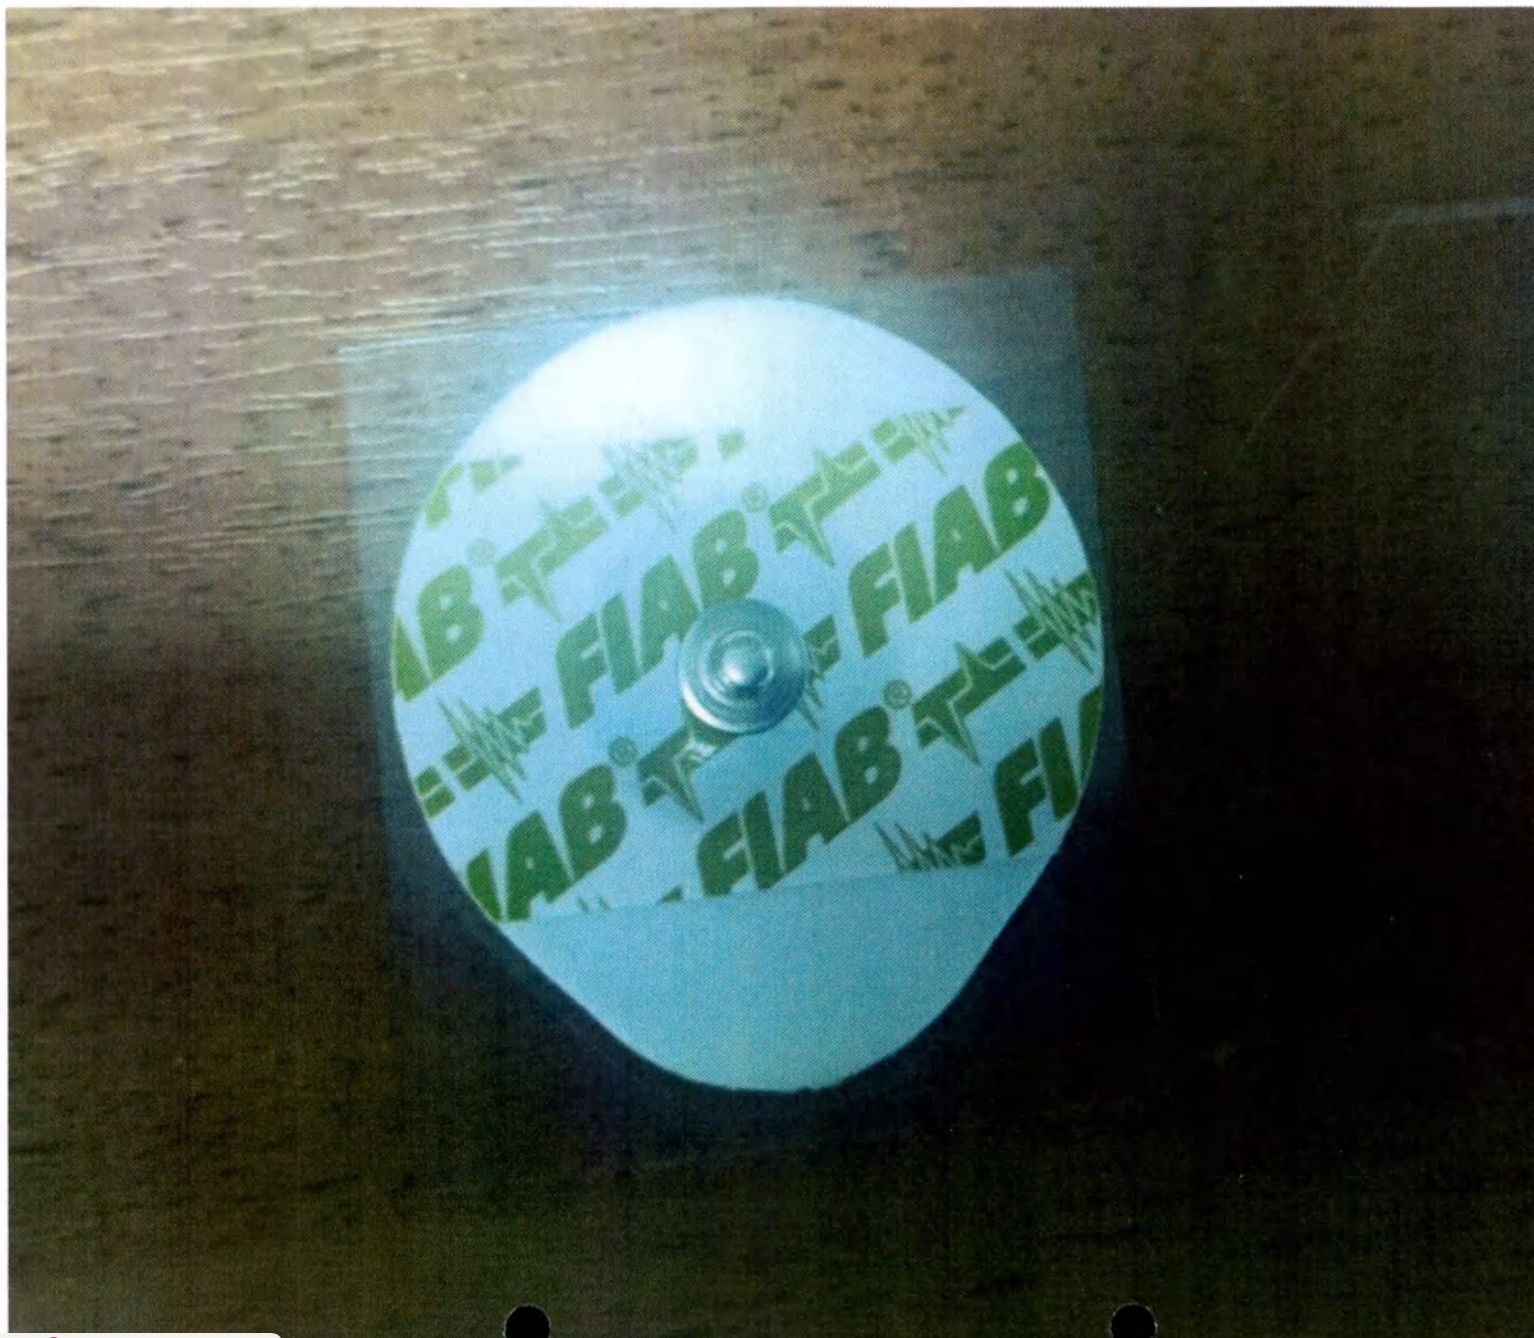

25. Электроды для ЭКГ, PG10S/RU2330W-DIN,
рег. удостоверение № ФСЗ 2010/07536, FIAB SpA, Италия

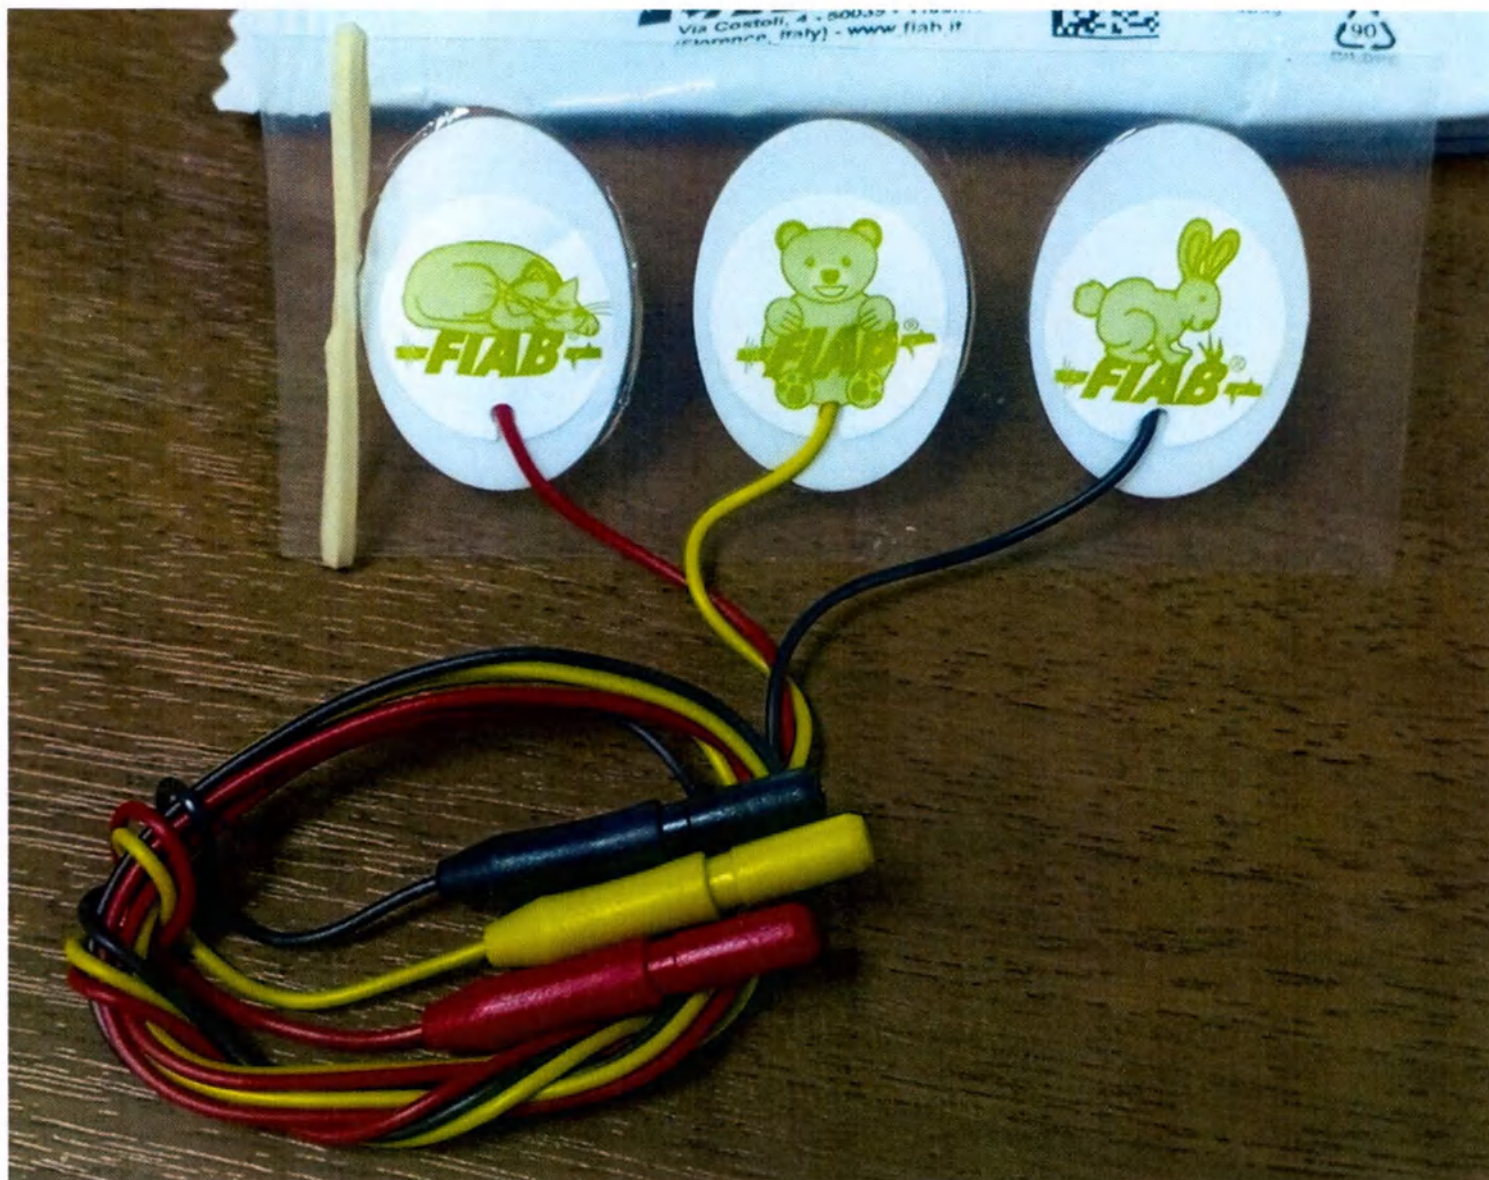

26. Электроды для ЭКГ, F9079/RU3236-100,
рег. удостоверение № ФСЗ 2010/07536, FIAB SpA, Италия




27. Датчик температуры поверхностный, РМ501.25.000,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




28. Датчик температуры универсальный, РМ321.21.000,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



29. Датчик температуры одноразовый, поверхностный, ТЭСМ.096019,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

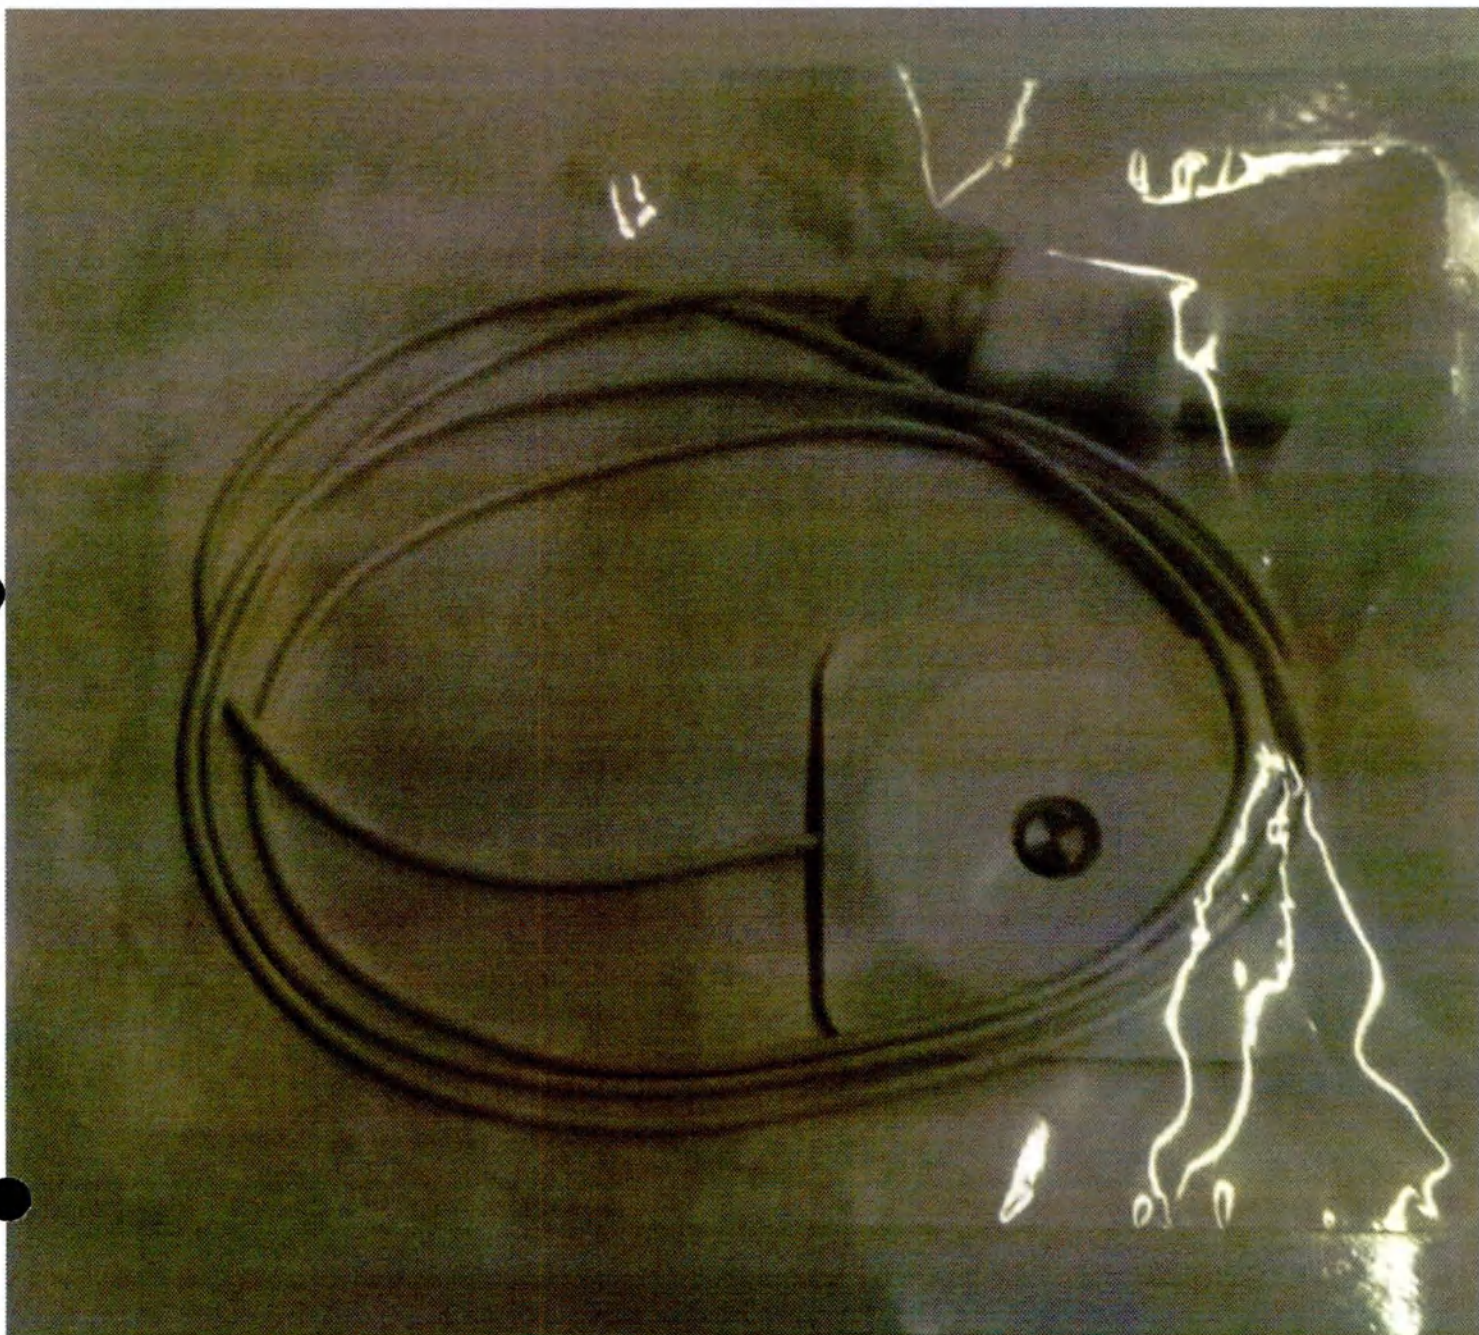

30. Датчик температуры одноразовый, универсальный, ТЭСМ.096020,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

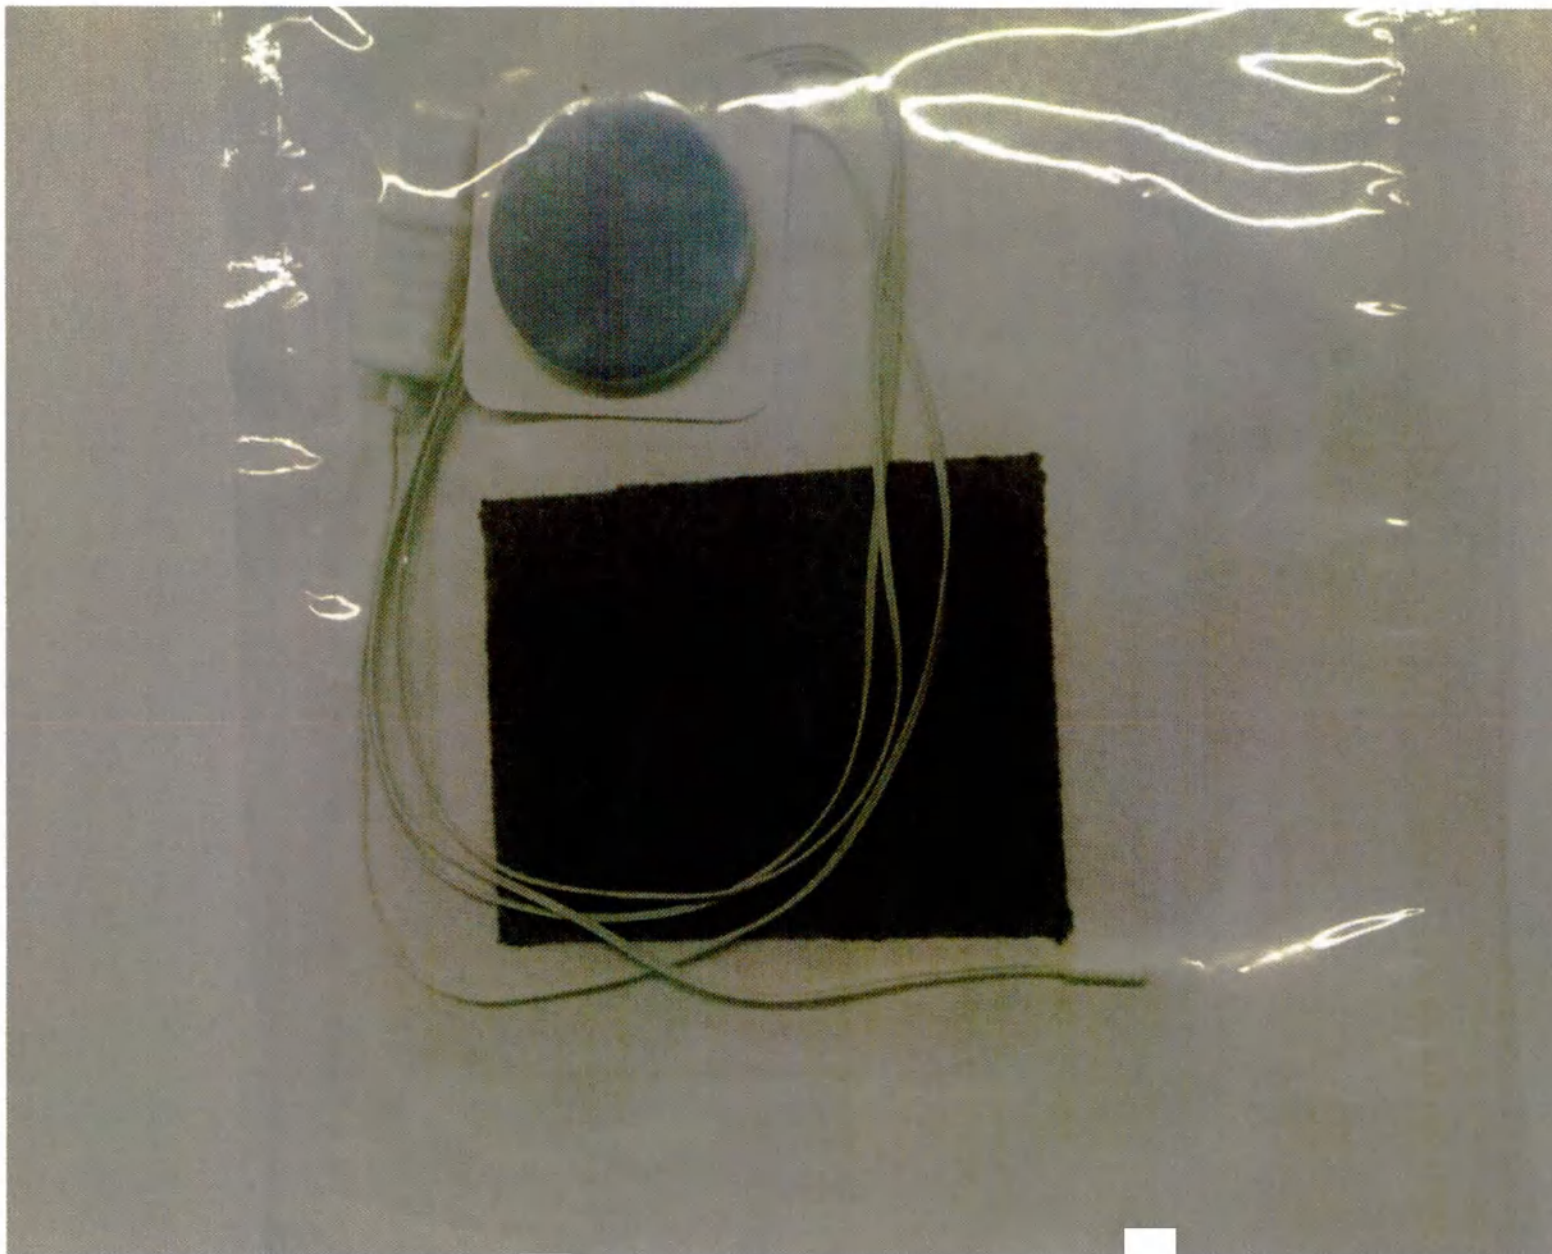

31. Переходник датчика температуры, ТЭСМ.096018,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



32. Манжета НИАД ТЭСМ.536404,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



33. Манжета НИАД ТЭСМ.536404-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




34. Манжета НИАД ТЭСМ.536404-02, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



35. Манжета НИАД, одноразовая, неонатальная ТЕСН.536405
(размер 1, 3-6 см), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



36. Манжета НИАД, одноразовая, неонатальная ТЕСН.536405-01
(размер 2, 4-8 см), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

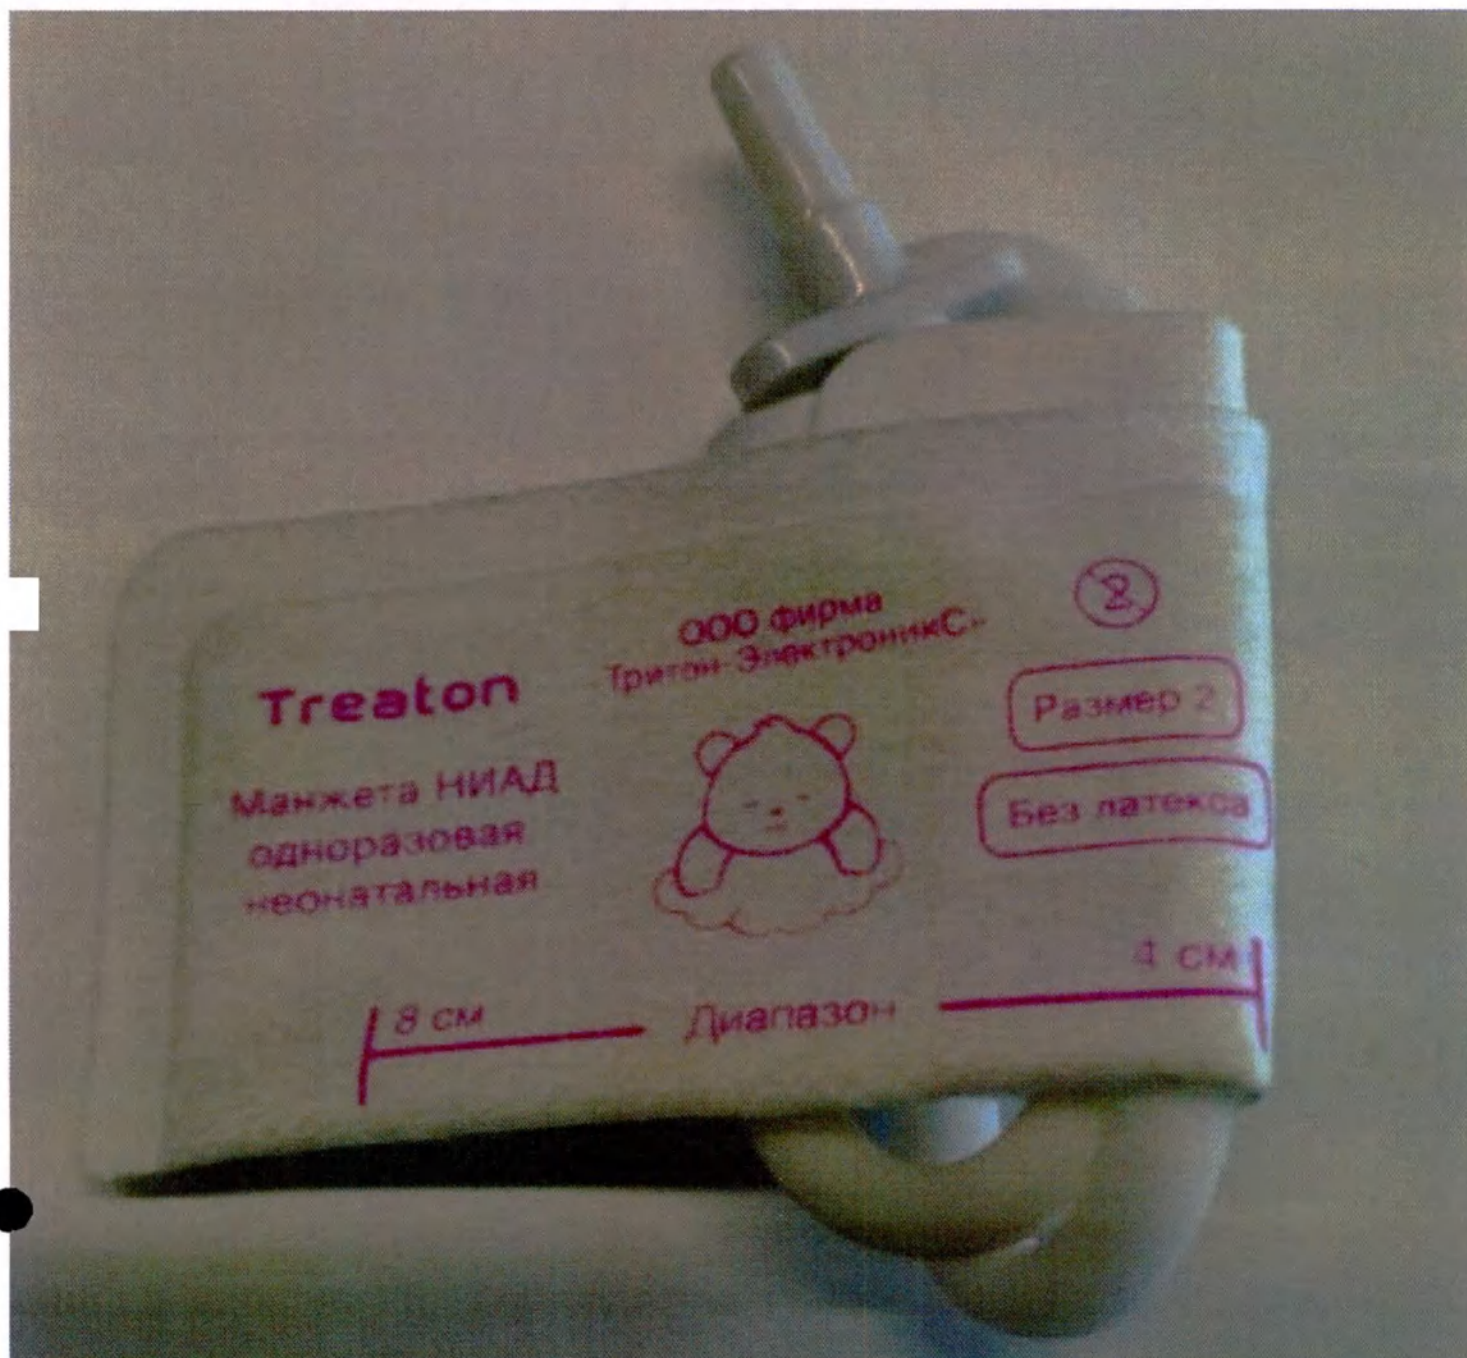

37. Манжета НИАД, одноразовая, неонатальная ТЕСН.536405-02
(размер 3, 6-11 см), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




38. Манжета НИАД, одноразовая, неонатальная ТЕСН.536405-03
(размер 4, 7-14 см), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



39. Шланг для манжеты, ТЭСМ.536128,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



40. Кабель питания для подключения к внешнему источнику постоянного тока, ТЭСМ.324001,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

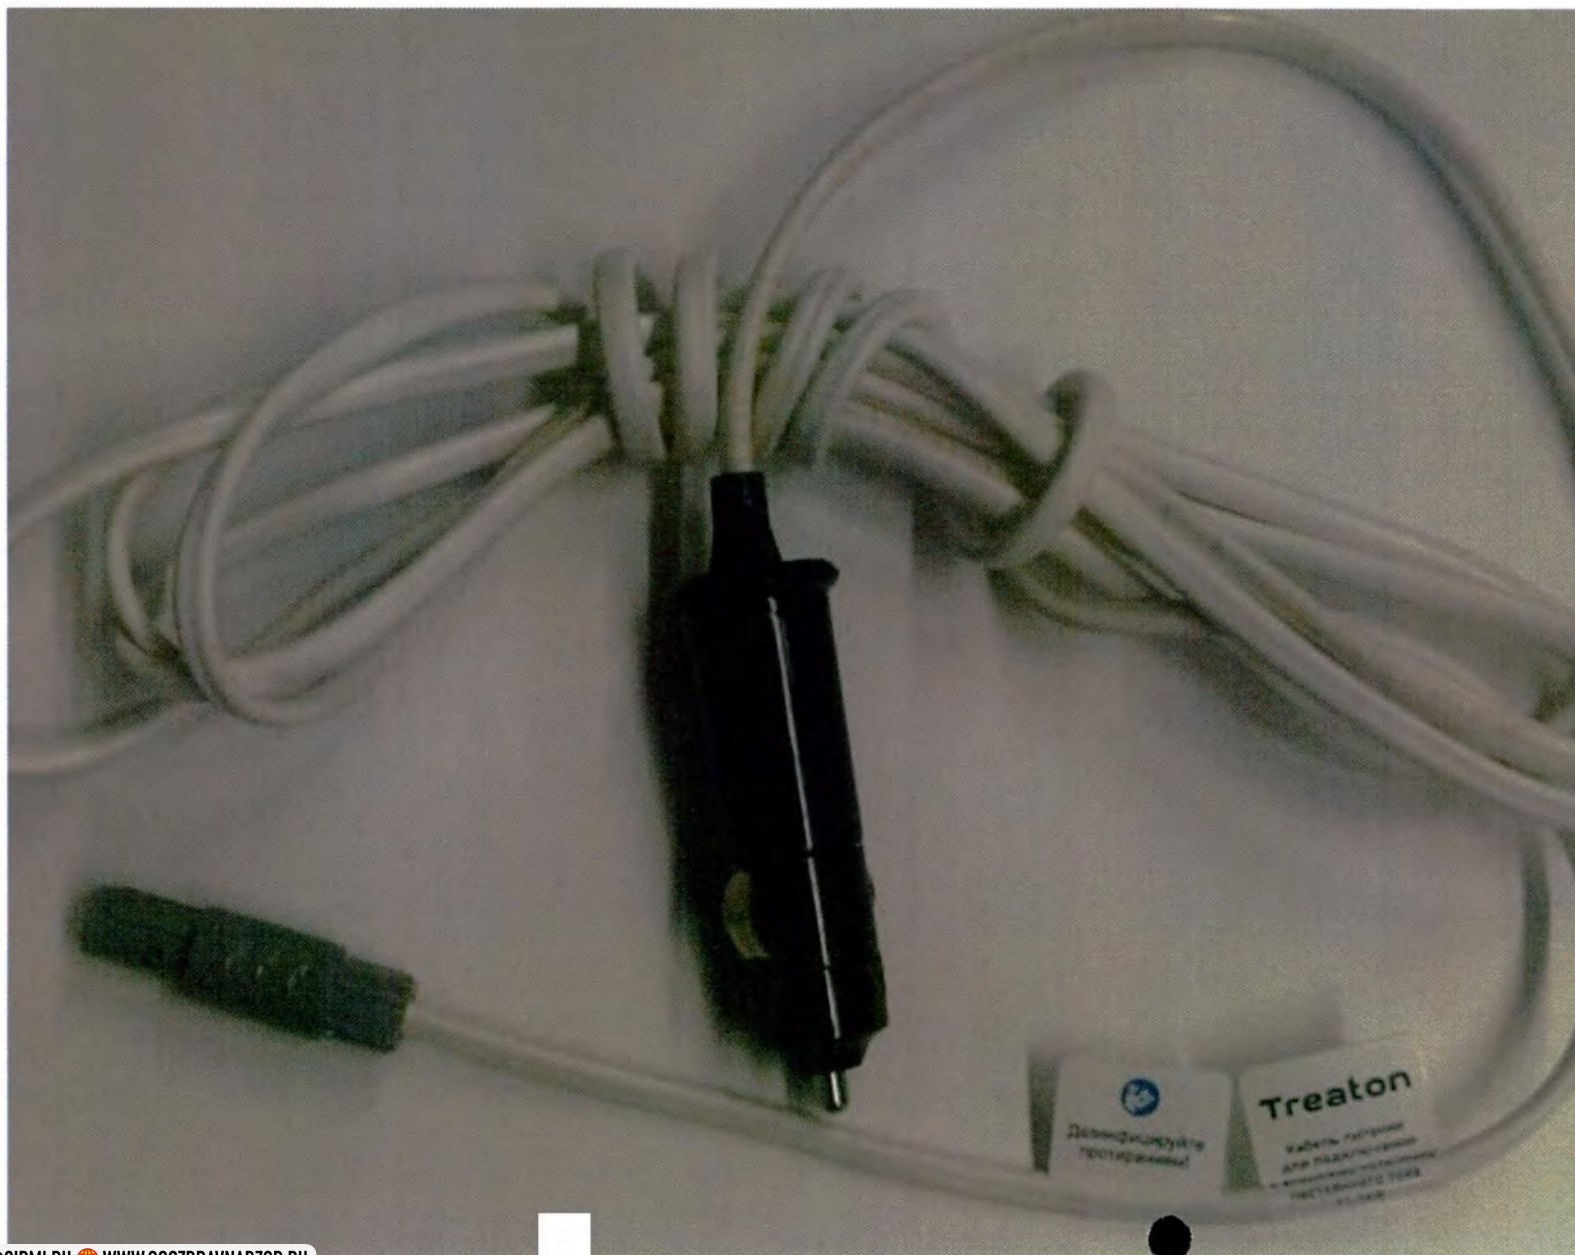


41. Кабель питания для подключения к внешнему источнику постоянного тока,
ТЭСМ.324001-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



42. Установочное оборудование, ТЭСМ.533002-02,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




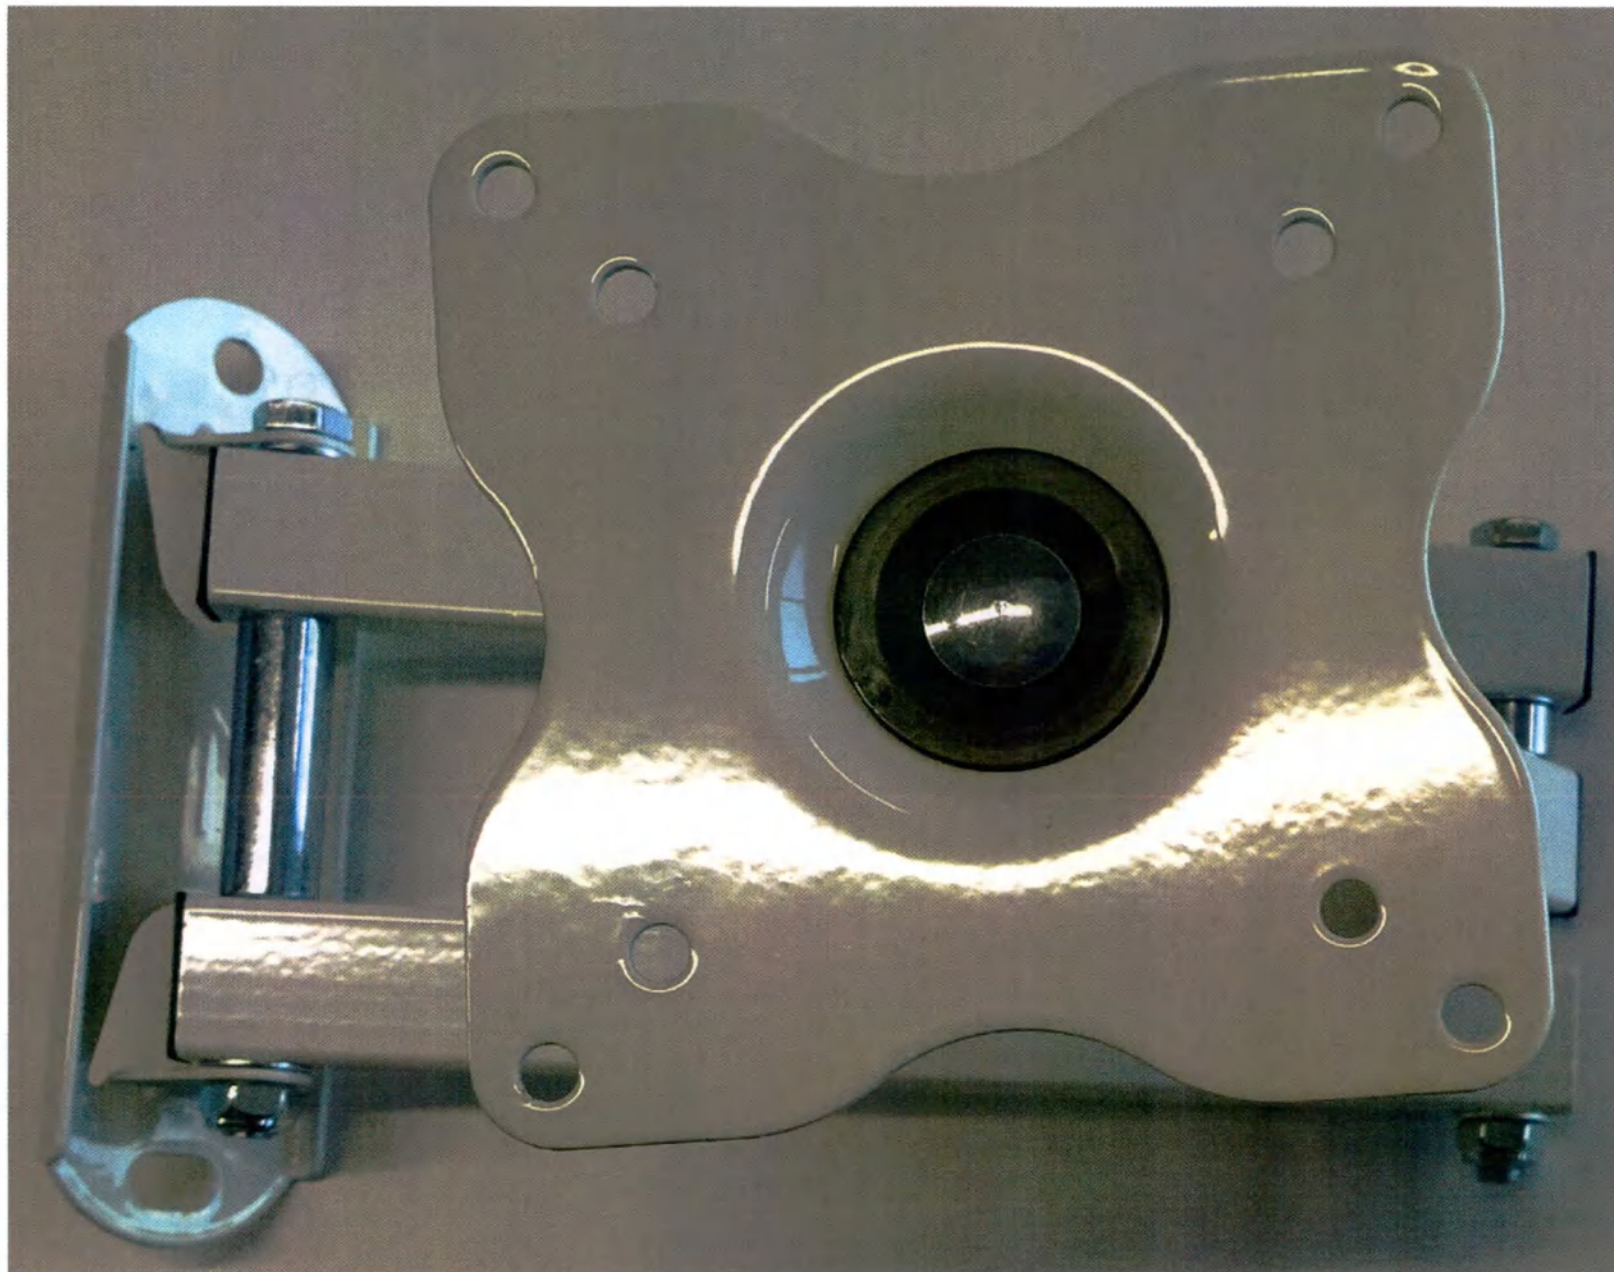

44. Модуль оценки глубины анестезии и седации ТЭСМ.943129.007,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



45. Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, ТЕСН.516118,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

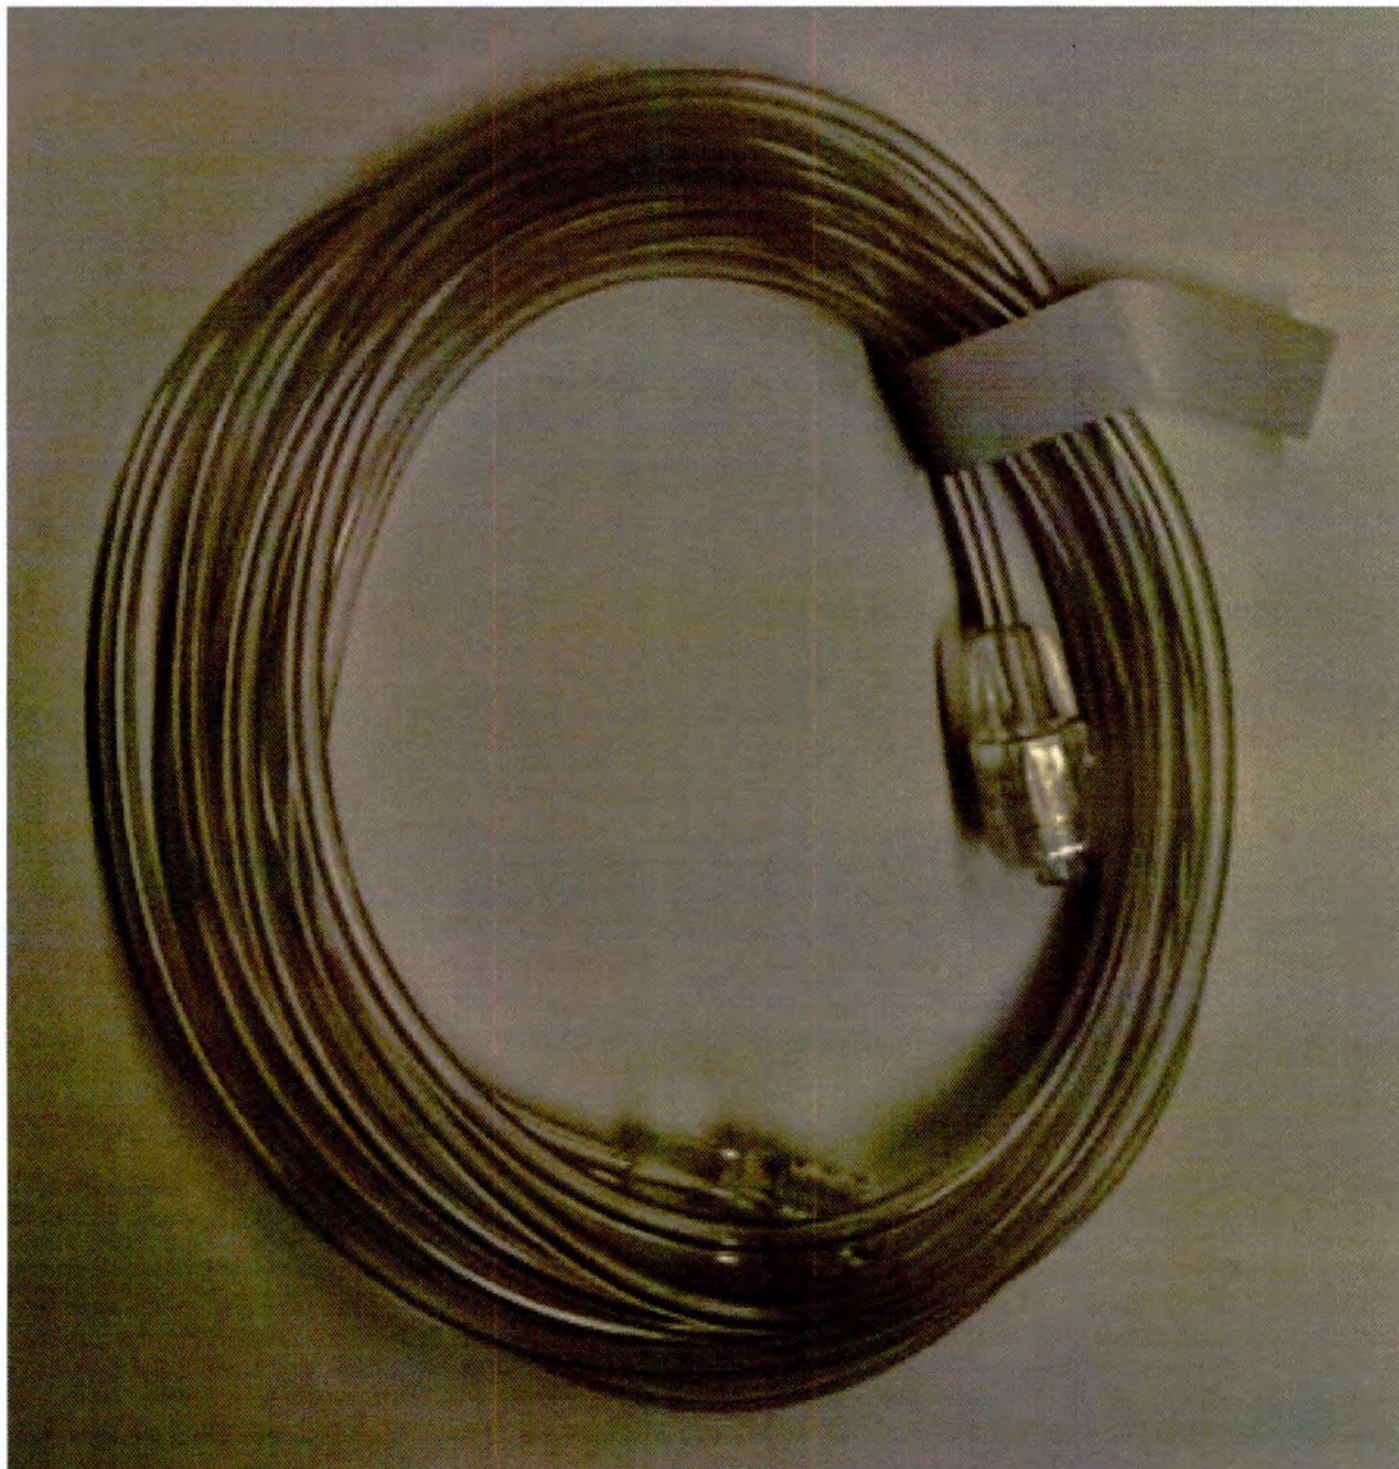

46. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии, в составе: Линия мониторинга в комплекте с соединителями, без фильтра: линия мониторинга содержания углекислого газа, 2732000 (2,45 м), рег. удостоверение № ФСЗ 2009/03551, Intersurgical Ltd., Великобритания



47. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии, в составе: Линия мониторинга в комплекте с соединителями, без фильтра: линия мониторинга содержания углекислого газа, 2725000 (1,8 м), рег. удостоверение № ФСЗ 2009/03551, Intersurgical Ltd., Великобритания



48. Влагоотделитель, взрослый/детский 60-13100-00 DRYLINE™ Water Trap,
Adult, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., KHP.



49. Влагоотделитель, неонатальный 60-13200-00 DRYLINE™ Water Trap, Neonate,
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., KHP




50. Датчик потока, ТЕСН.096026, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




51. Устройство для контроля кровяного давления КОМБИТРАНС (Combitrans) вариант исполнения: Набор для контроля давления с преобразователем КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set), 5202604, рег. удостоверение № РЗН 2013/245, В. BRAUN Melsungen AG, Германия



52. Устройство для контроля кровяного давления КОМБИТРАНС (Combitrans) вариант исполнения: Набор для контроля давления с преобразователем КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set), 5202620, рег. удостоверение № РЗН 2013/245, В. BRAUN Melsungen AG, Германия

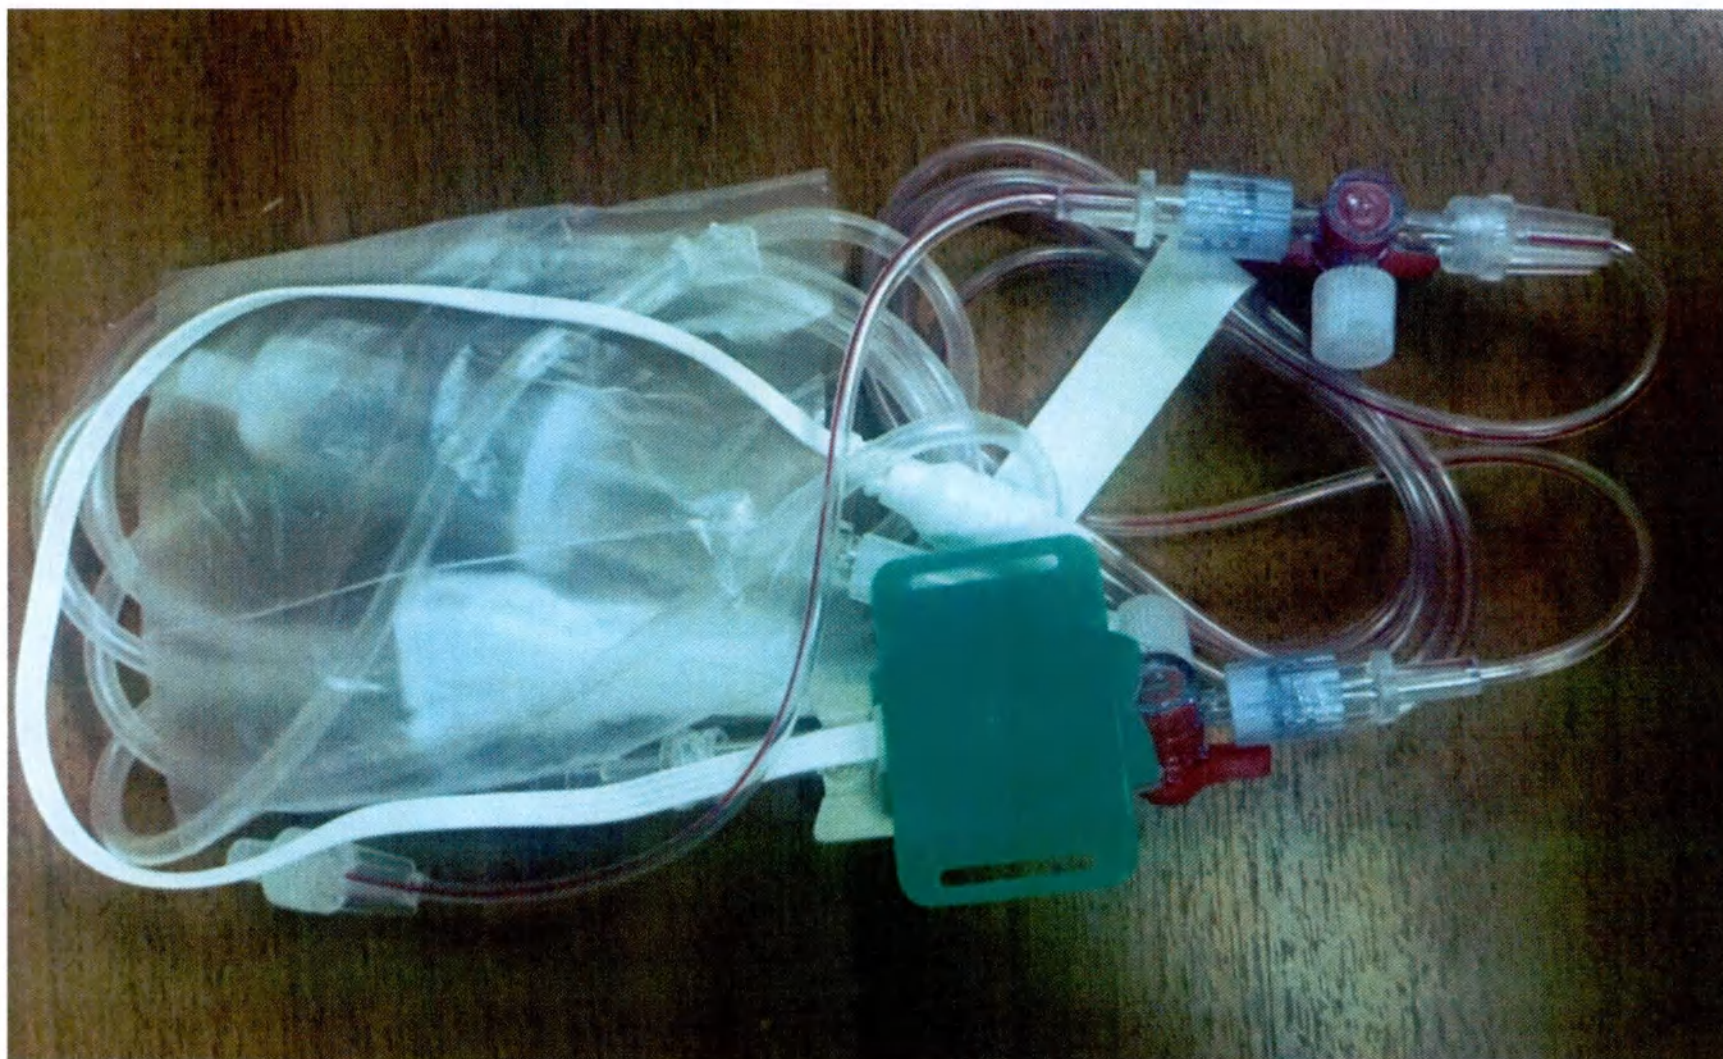


53. Устройство для контроля кровяного давления КОМБИТРАНС (Combitrans)
вариант исполнения: Набор для контроля давления с преобразователем
КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set), 5200830, рег. удостоверение № РЗН
2013/245, В. BRAUN Melsungen AG, Германия

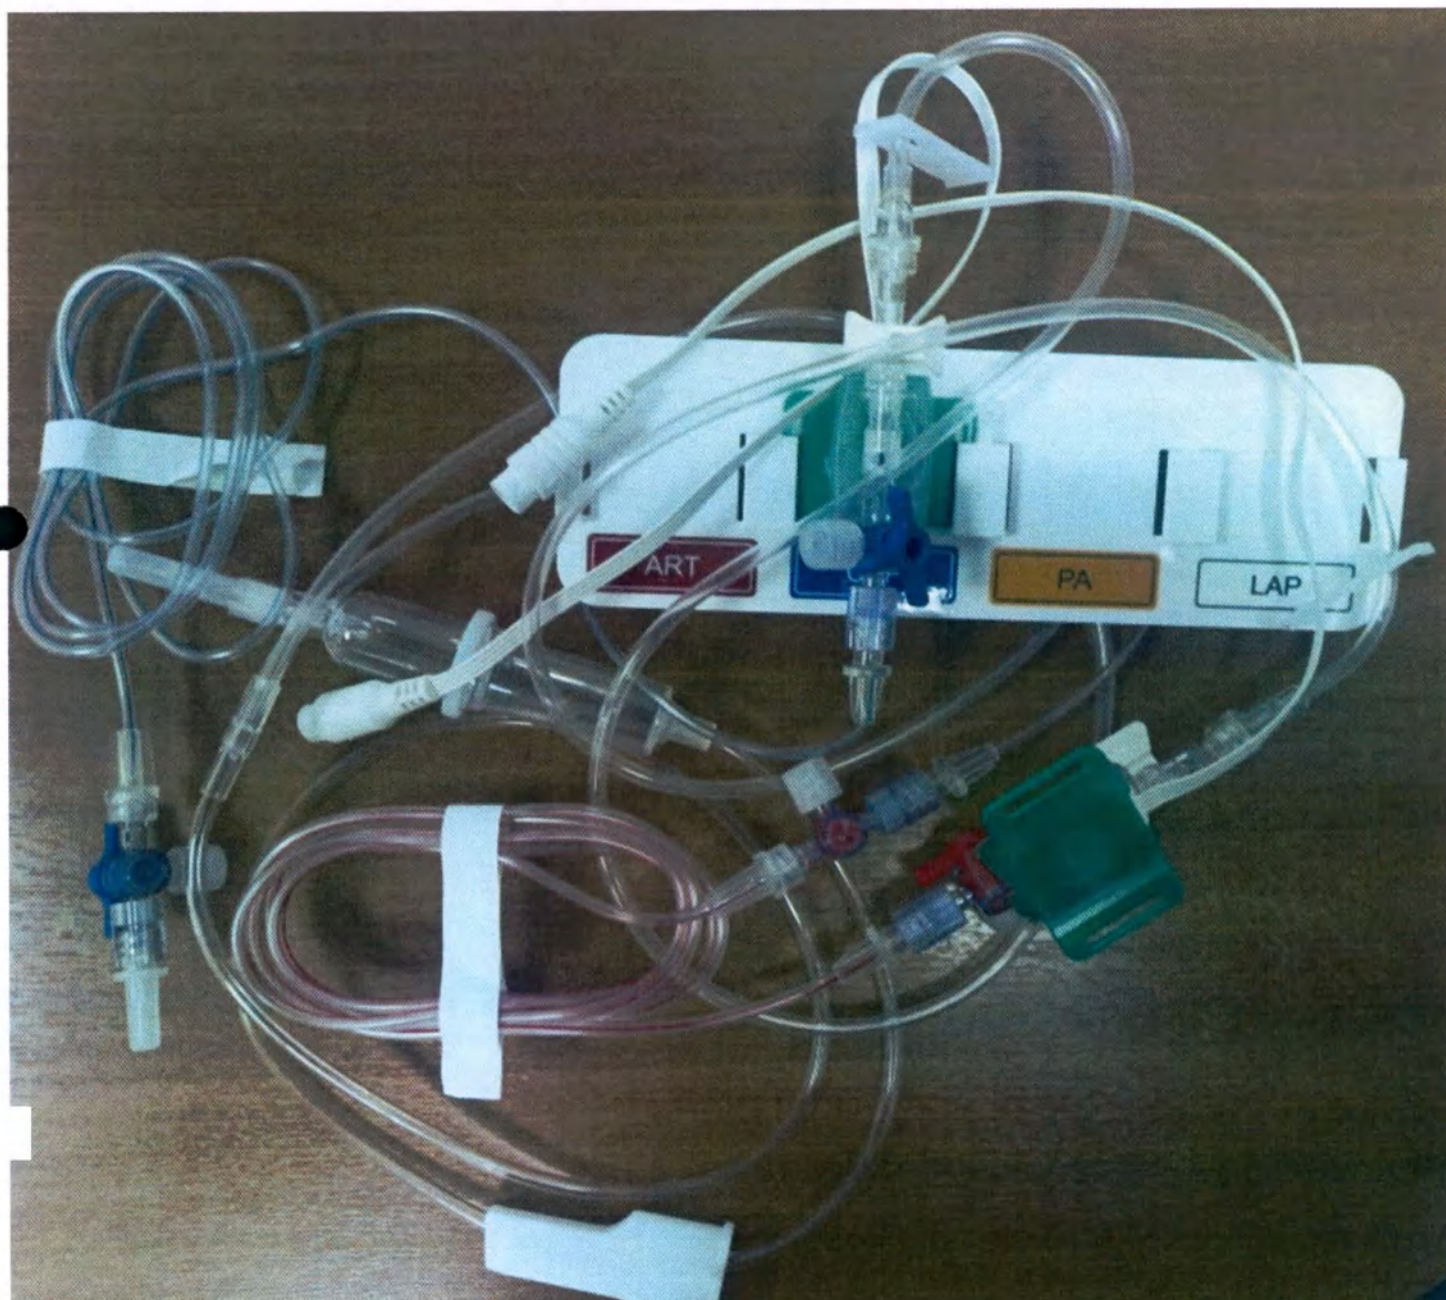

54. Устройство для контроля кровяного давления КОМБИТРАНС (Combitrans) вариант исполнения: Кабель соединительный КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring cable), 5203511, рег. удостоверение № РЗН 2013/245, В. BRAUN Melsungen AG, Германия

53



55. Кабель ИАД, ТЕСН.514018, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



**Монитор прикроватный
реаниматолога и анестезиолога переносный
МНР6-03-«ТРИТОН»**

Паспорт
PM501.01.000-01-01 ПС



Редакция 13, 06/2024

56. Паспорт, PM501.01.000-01-01 ПС, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

**Монитор прикроватный
реаниматолога и анестезиолога
переносный
МПР6-03-«ТРИТОН»**


Исполнение 1

Руководство по эксплуатации
PM501.01.000-01-01 РЭ



Редакция 8, 06/2024

57. Руководство по эксплуатации. Исполнение 1, PM501.01.000-01-01 РЭ,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

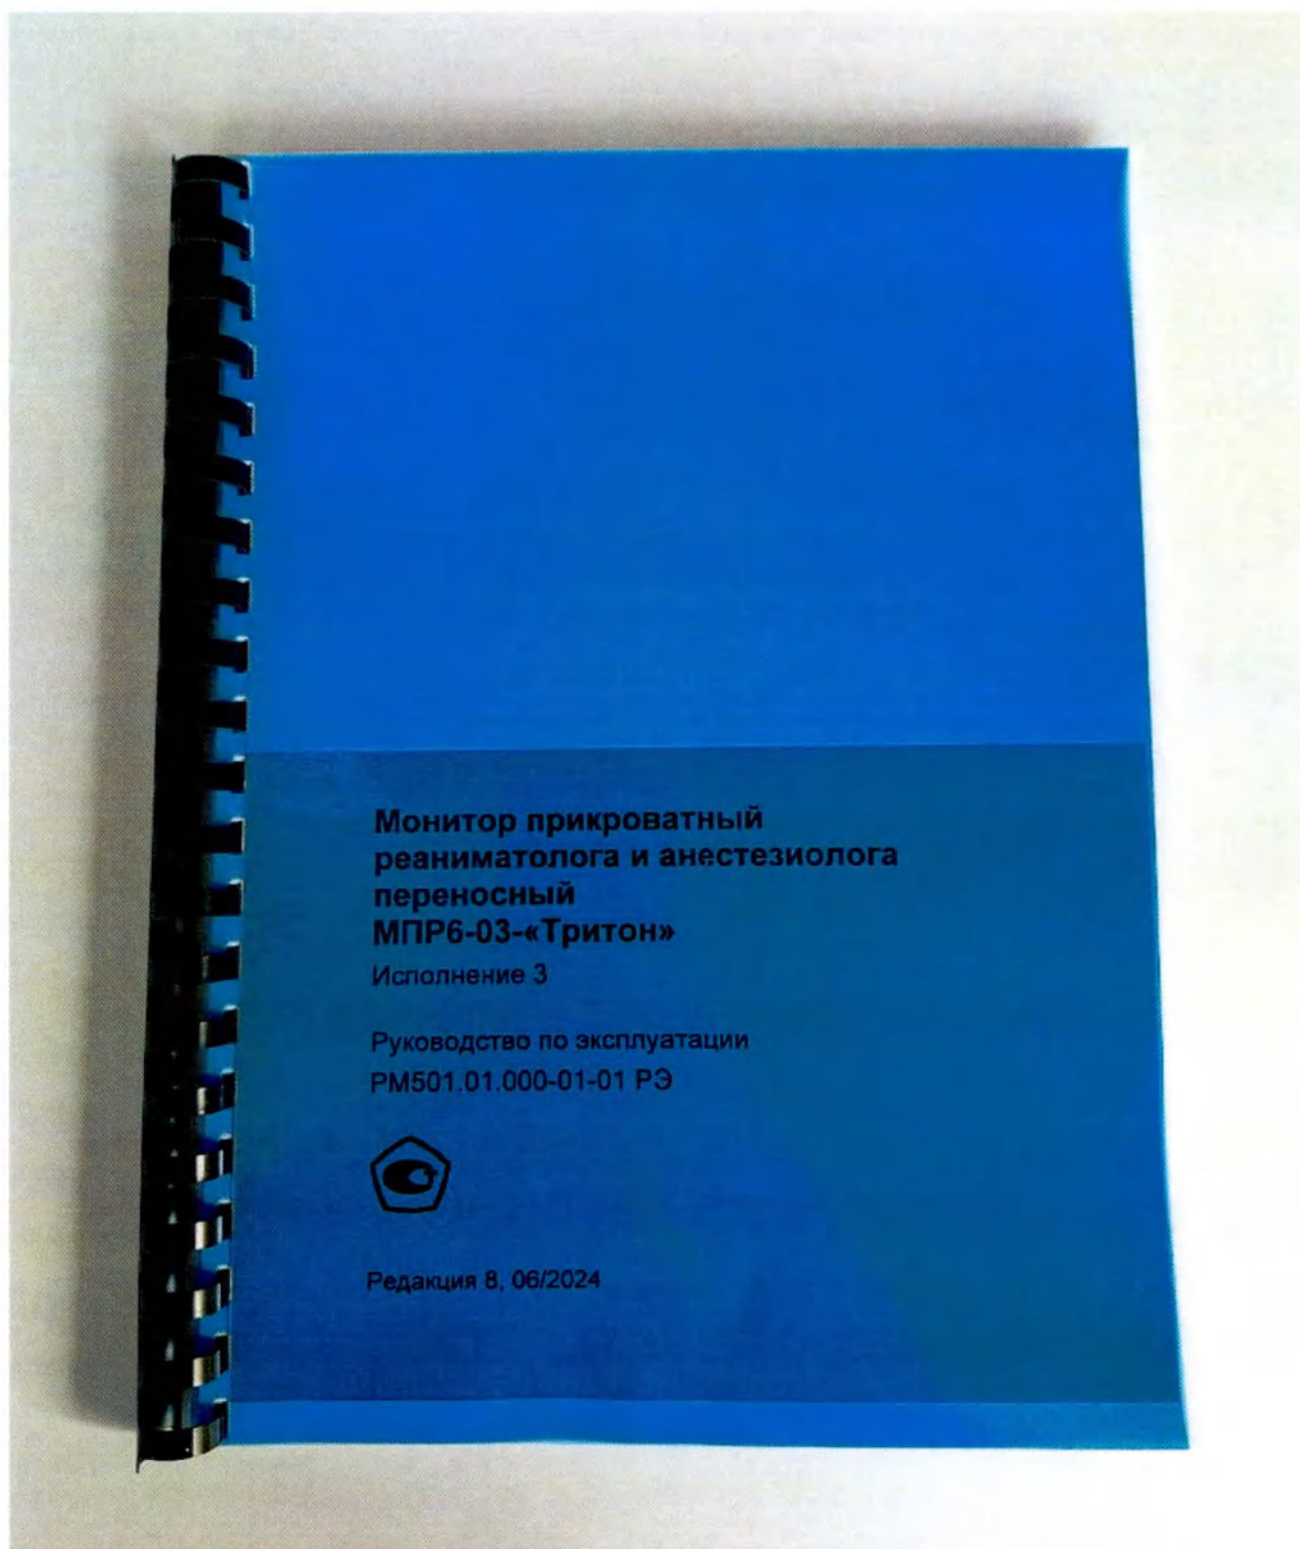

58. Руководство по эксплуатации. Исполнение 3, РМ501.01.000-01-01 РЭ, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

59. Упаковка транспортная, ТЭСМ.023001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия












60. Упаковка транспортная, ТЭСМ.533001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия





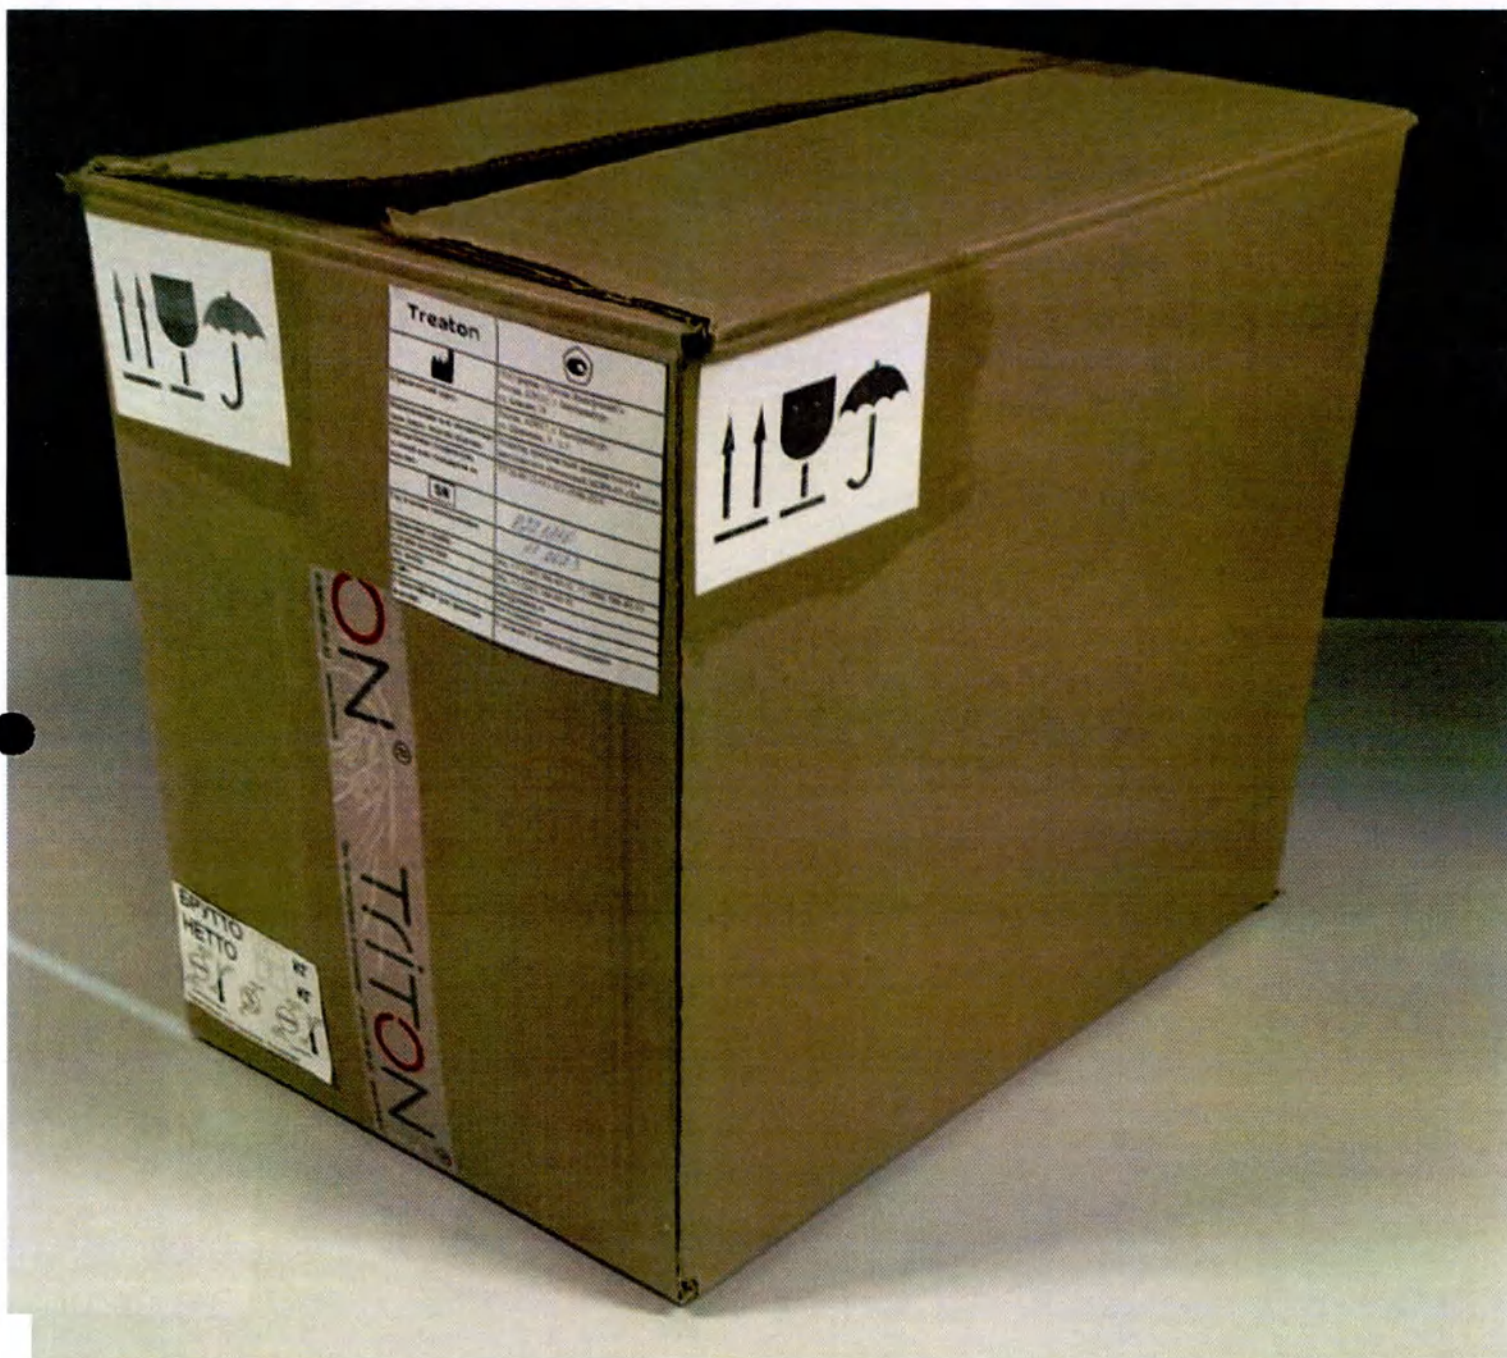

Прошито, пронумеровано,
скреплено печать 65 лист 06
Генеральный директор
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



Полунин В. М

06 2024г.