

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Облучатель медицинский бактерицидный "Азов"
по ТУ 9444-015-03965956-2008»**


Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-35 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008



Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-75 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008



Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008

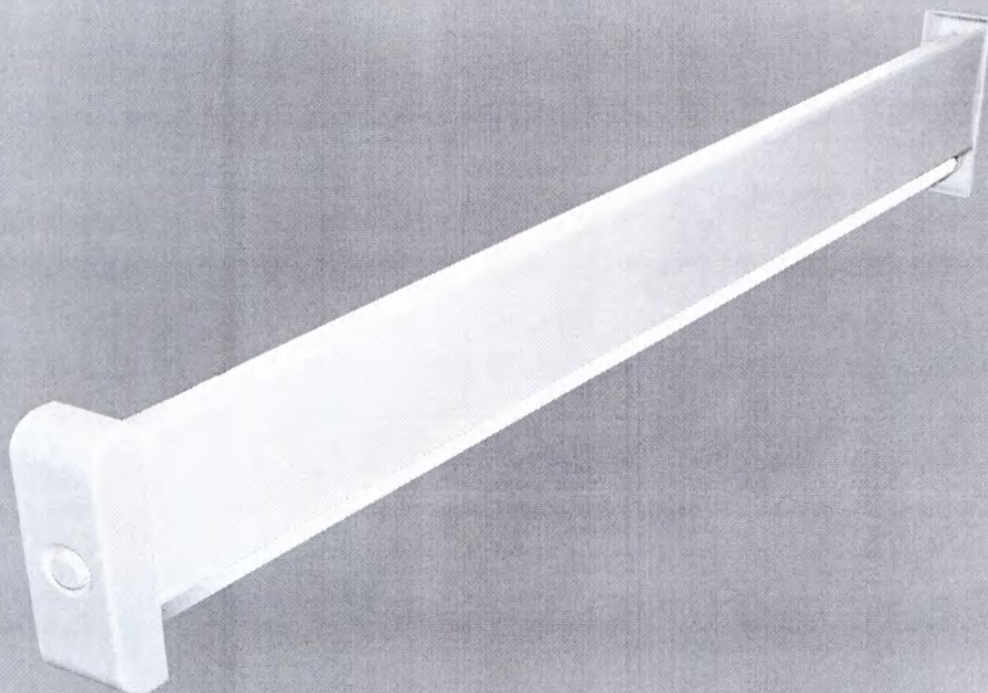

ELID

EAC




Облучатель медицинский
бактерицидный ОБН-150 "Азов"

ТУ 9444-015-03965956-2008

~220 В., 50Гц., 2х30 Вт., УХЛ4.2


дата выпуска: 01. 2020 г.

Облучатель медицинский бактерицидный ОБП-300 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008

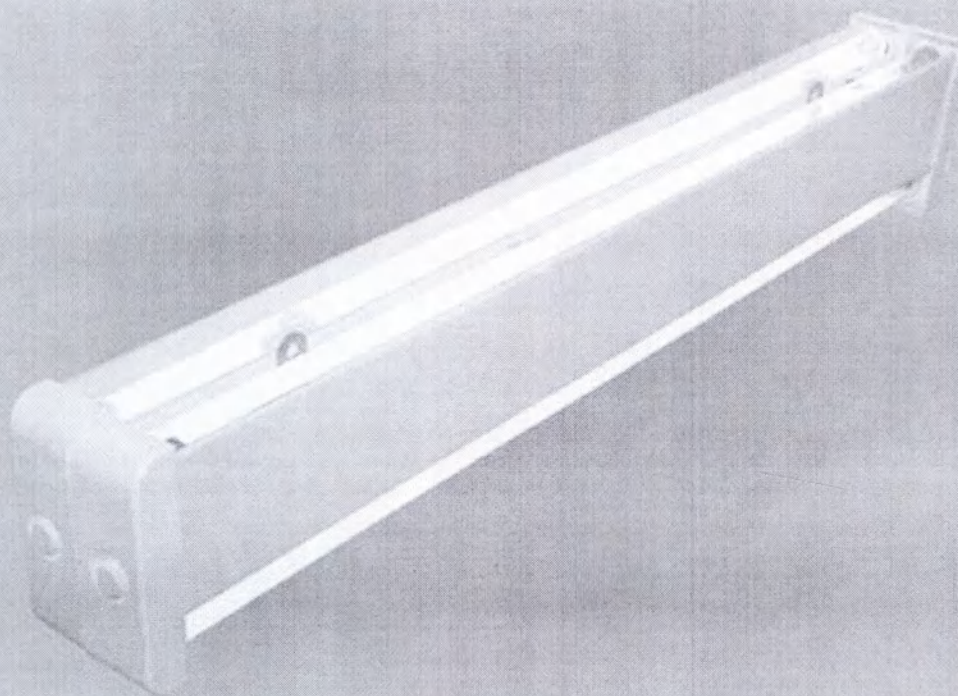


Облучатель медицинский
ELID бактерицидный "Азов" ОБП-300
ТУ 9444.015.03965956-2008
EAC  ~220 В., 50 Гц., 4x30 Вт., УХЛ 4.2
01. 2020 г.

Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-300 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008

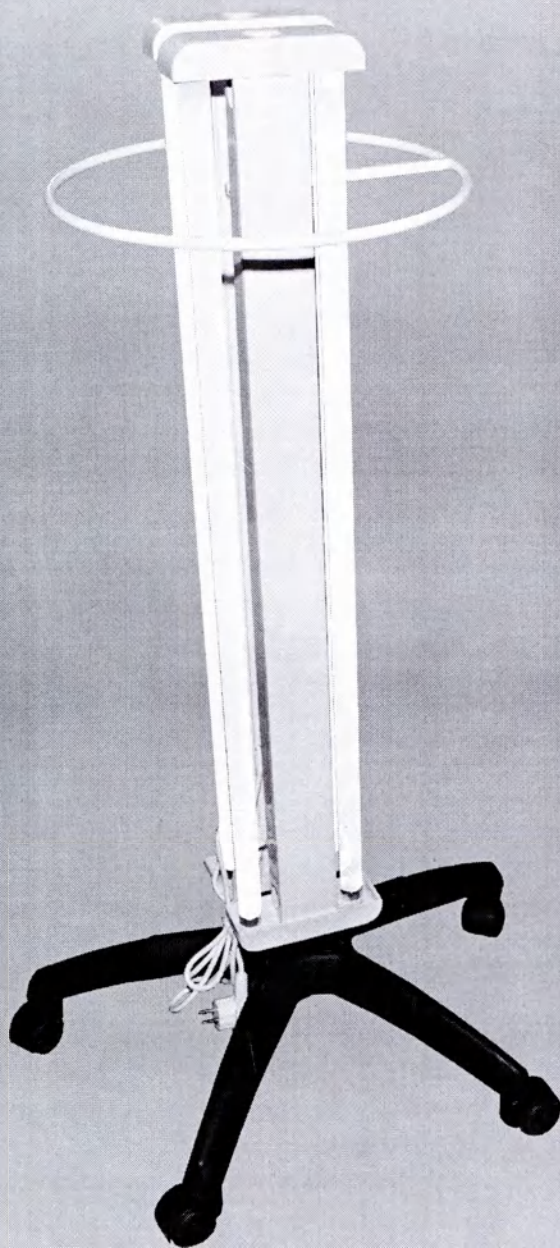


Облучатель медицинский
ELID бактерицидный "Азов" ОБПе-300
ТУ 9444-015-03965956-2008
EAC  ~220 В., 50 Гц., 4х30 Вт., УХЛ 4.2
01. 2020 г.

Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-450 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008.

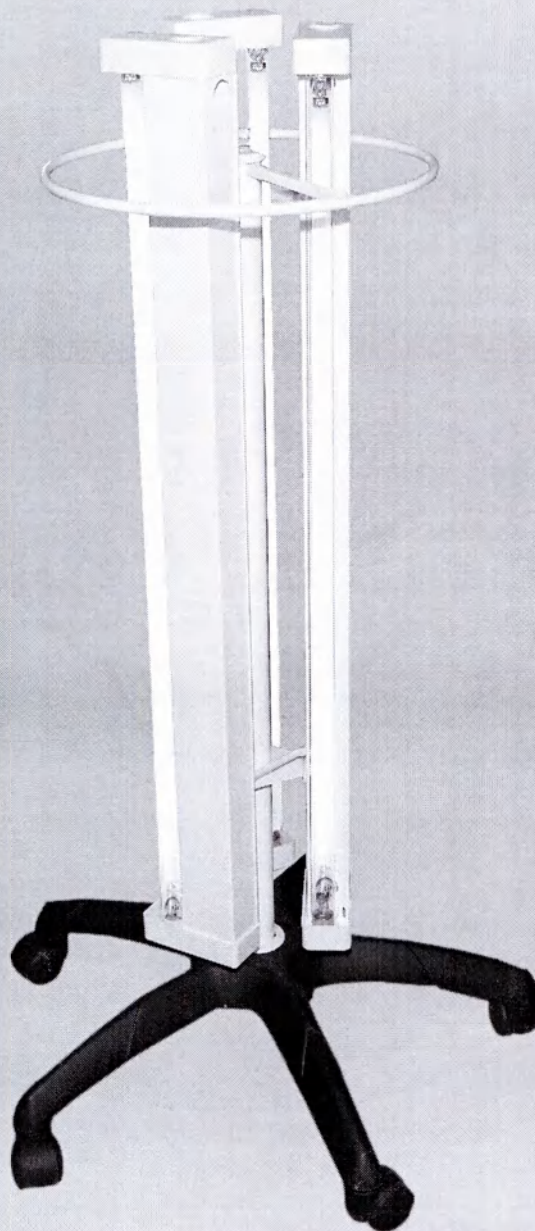

ELID

EAC




Облучатель медицинский
бактерицидный "Азов" ОБПе-450
ТУ 9444-015-03965956-2008

~220 В., 50Гц., 6х30 Вт., УХЛ4.2

дата выпуска: 01. 2020 г.

Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБРН-1х15 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008.

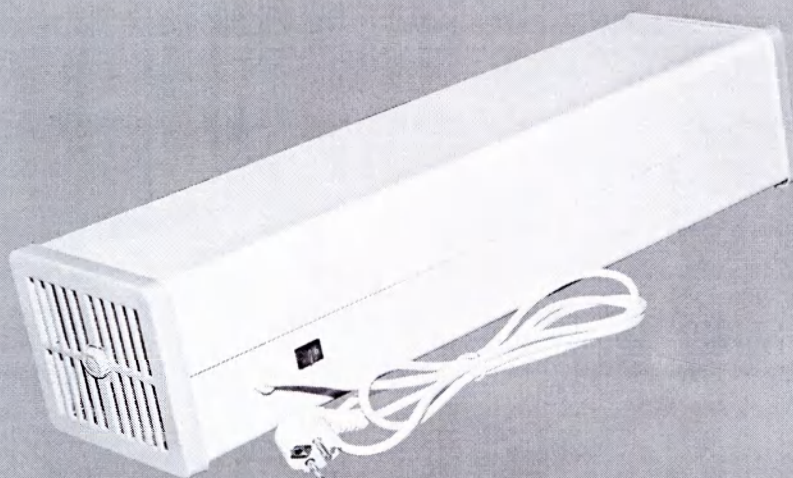


ELID

Облучатель медицинский
бактерицидный "Азов"

ОБРН - 1х15

EAC




ТУ 9444-015-03965956-2008

~220 В, 50Гц, 1х15 Вт, УХЛ 4.2

дата выпуска: 01 2020 г.

Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБРН-2х15 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008

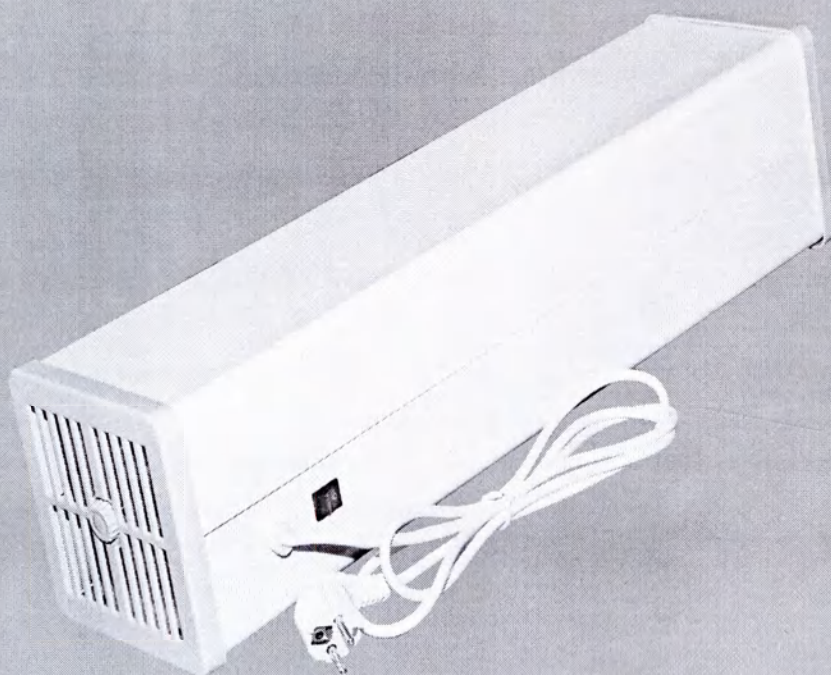

ELID




Облучатель медицинский
бактерицидный "Азов" ОБРН-2х15
ТУ 9444-015-03965956-2008

~220 В., 50 Гц., 2х15 Вт., УХЛ4.2


дата выпуска: 01. 2020 г

Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБРН-2х30 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008.

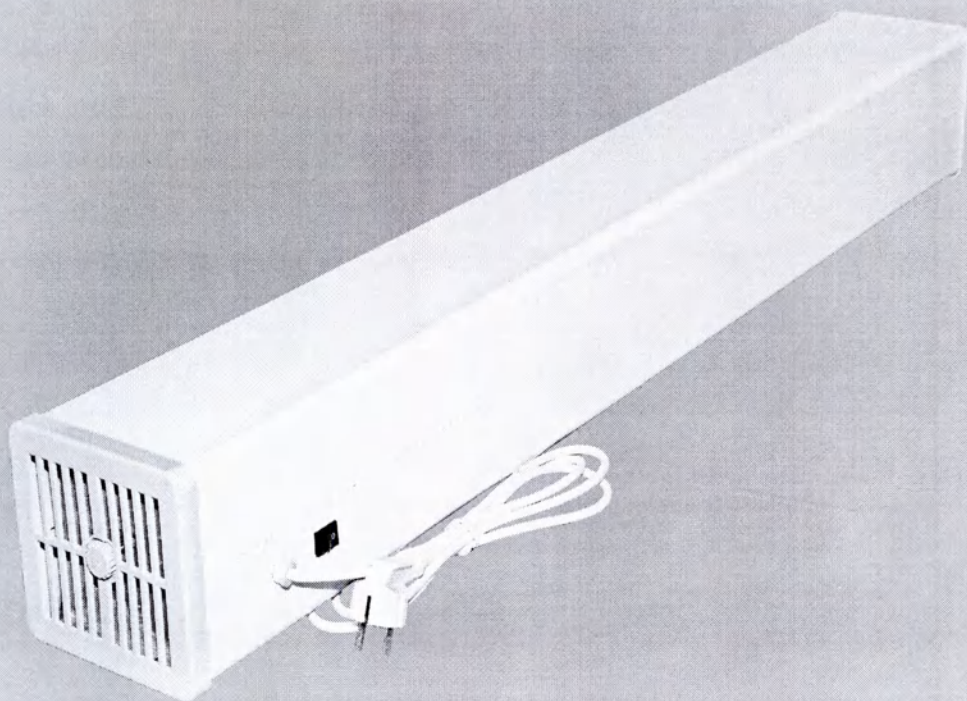

ELID


EAC



Облучатель медицинский
бактерицидный "Азов" ОБРН-2х30
ТУ 9444-015-03965956-2008
~220 В, 50Гц, 2х30 Вт, УХЛ4.2


дата выпуска: 01. 2020 г.

Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБРПе-2х15 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008.

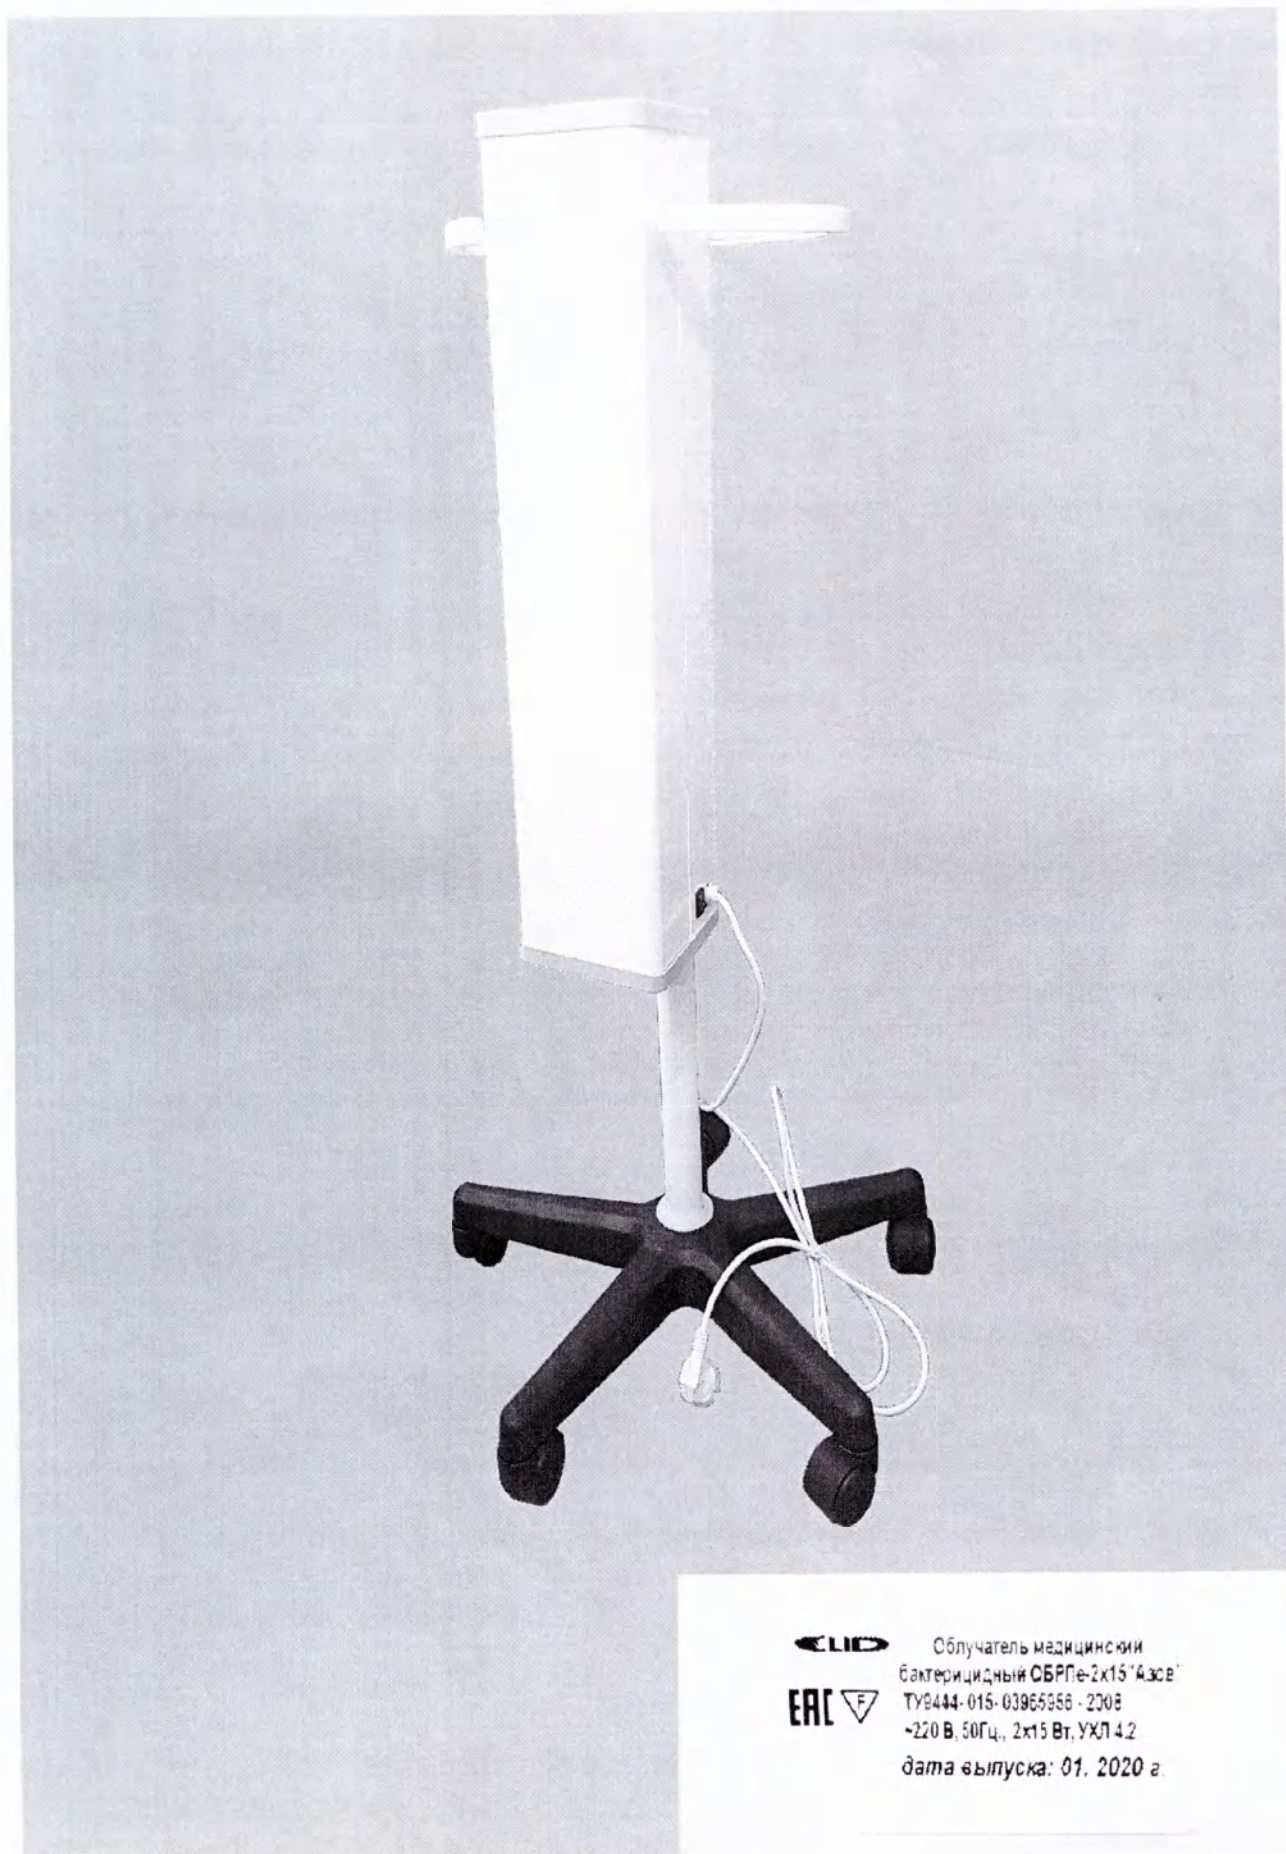

Облучатель медицинский
бактерицидный ОБРПе-2х15 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008
~220 В, 50 Гц., 2х15 Вт, УХЛ 4.2
дата выпуска: 01. 2020 г.

Облучатель рециркулятор медицинский бактерицидный ОБРПе-2х30 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008.

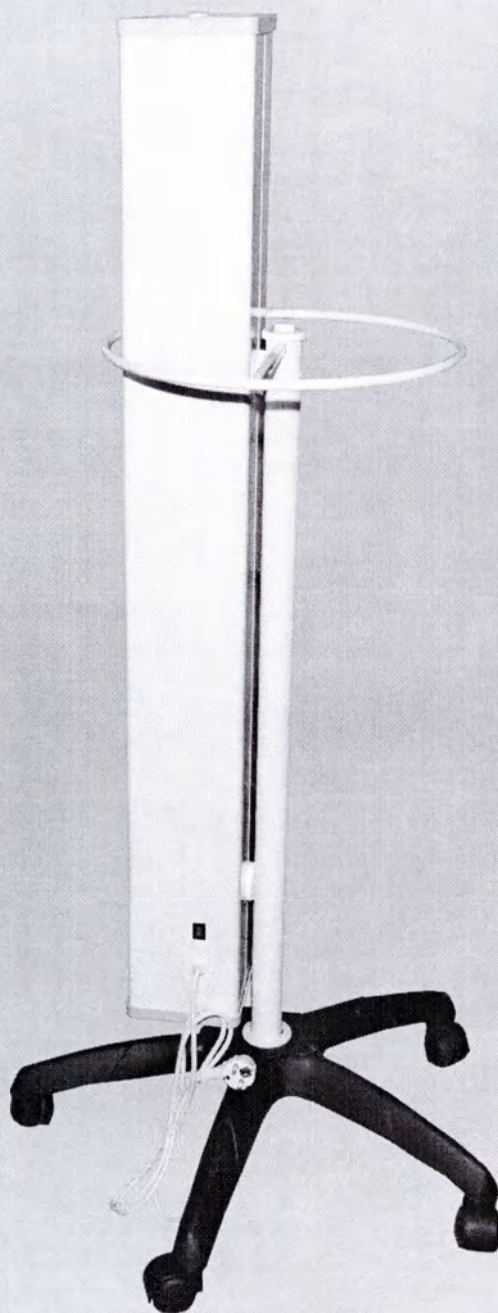

CLID

EAC 

Облучатель медицинский
бактерицидный ОБРПе-2х30 "Азов"
ТУ 9444-015-03965956-2008
~220 В, 50 Гц., 2х30 Вт, УХЛ 4.2
дата выпуска: 01. 2020 г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 12 лист(ов).

Должность, ФИО _____

инженер-технолог
Трягусова С.В.
(подпись) М.П.

« 27 » 12 2019 г.

