

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»



Н. А. Ларина/

«18» марта 2024 года

Фотографические изображения медицинского изделия

Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ

производства

Ningbo David Medical Device Co., Ltd.


(Нинбо Дэвид Медикал Девайс Ко., Лтд.), Китай

Оглавление


1	Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90L	3
2	Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90P.....	12
3	Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90Q.....	20
4	Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90S.....	27
5	Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-200.....	34

1 Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90L


1.1 Общий вид

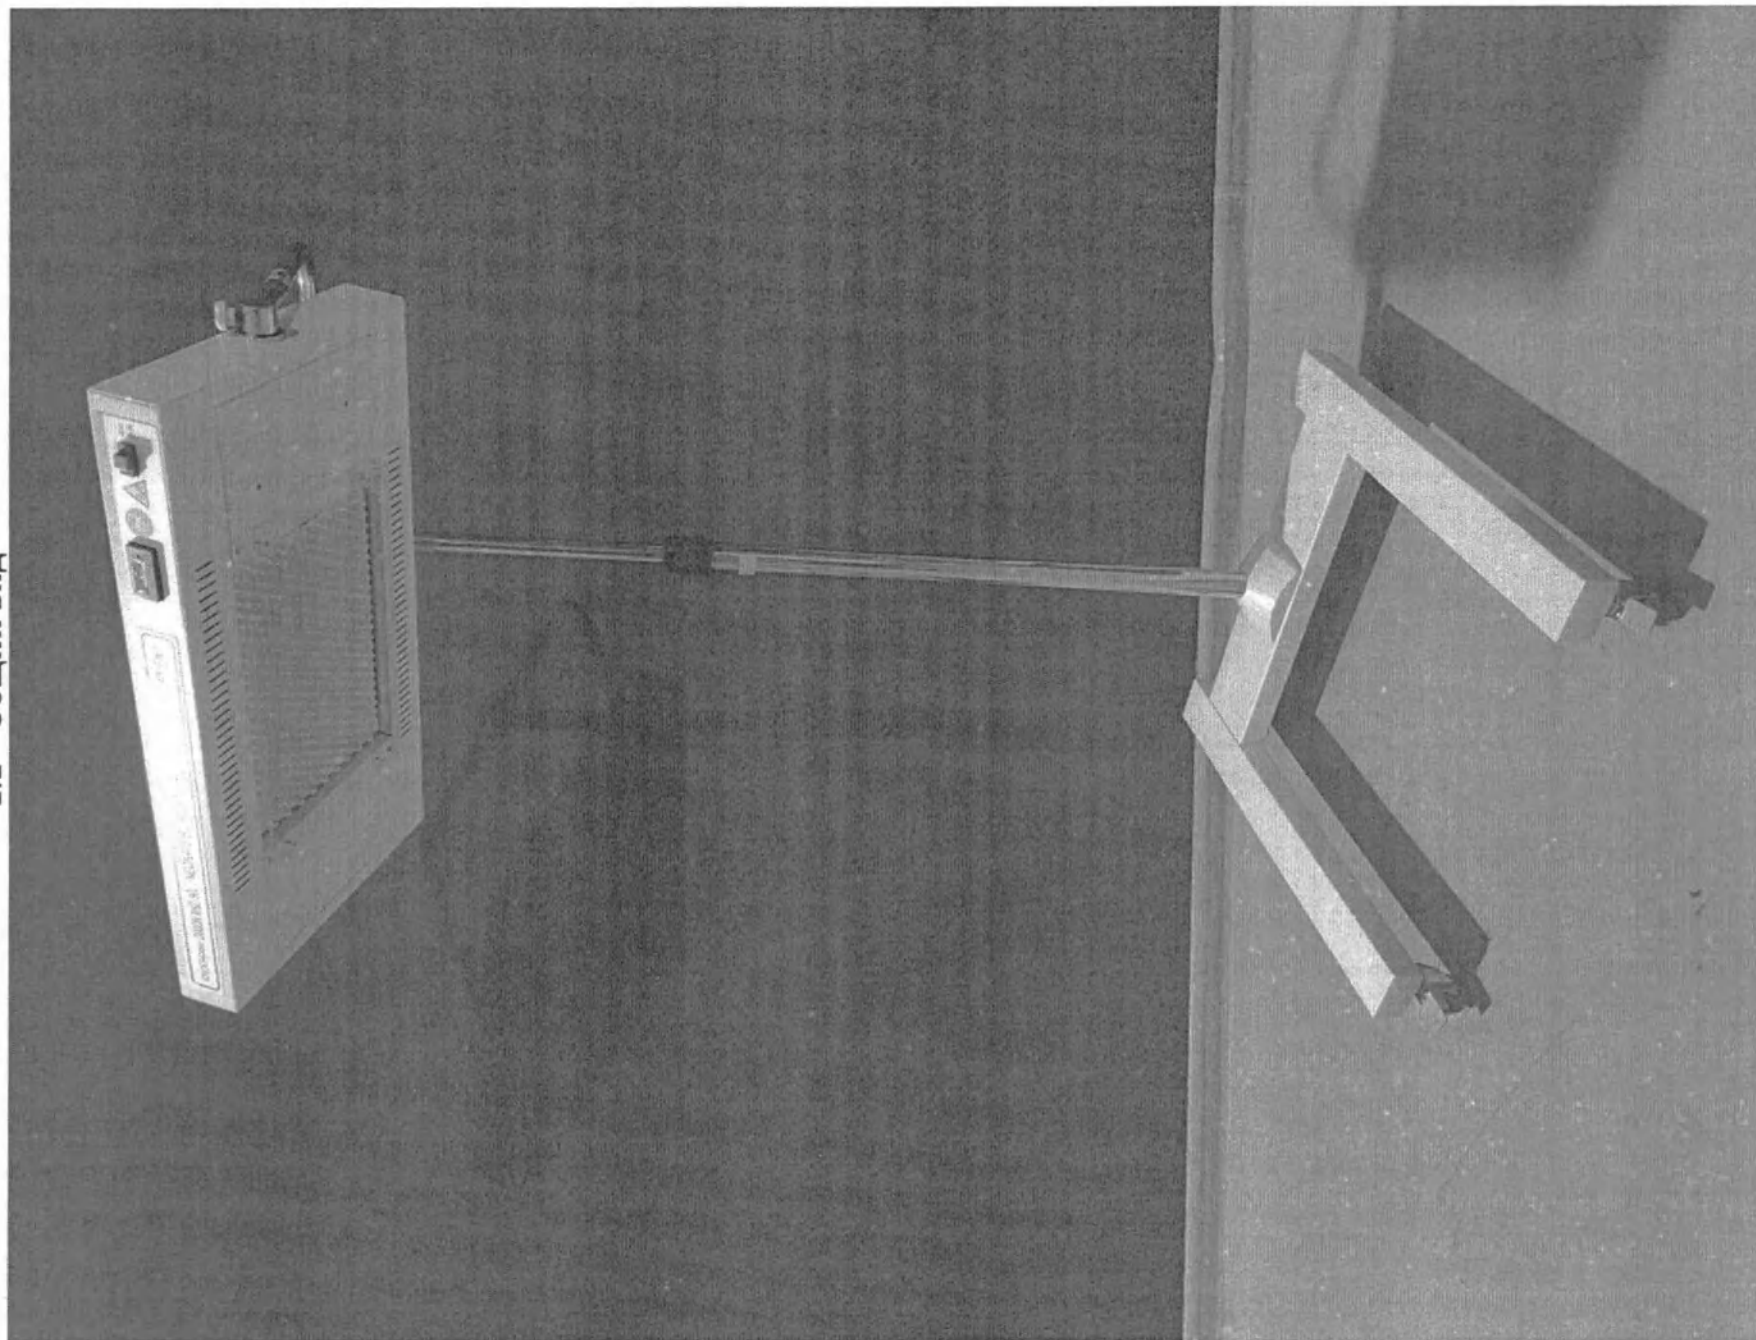


1.2 Основной блок

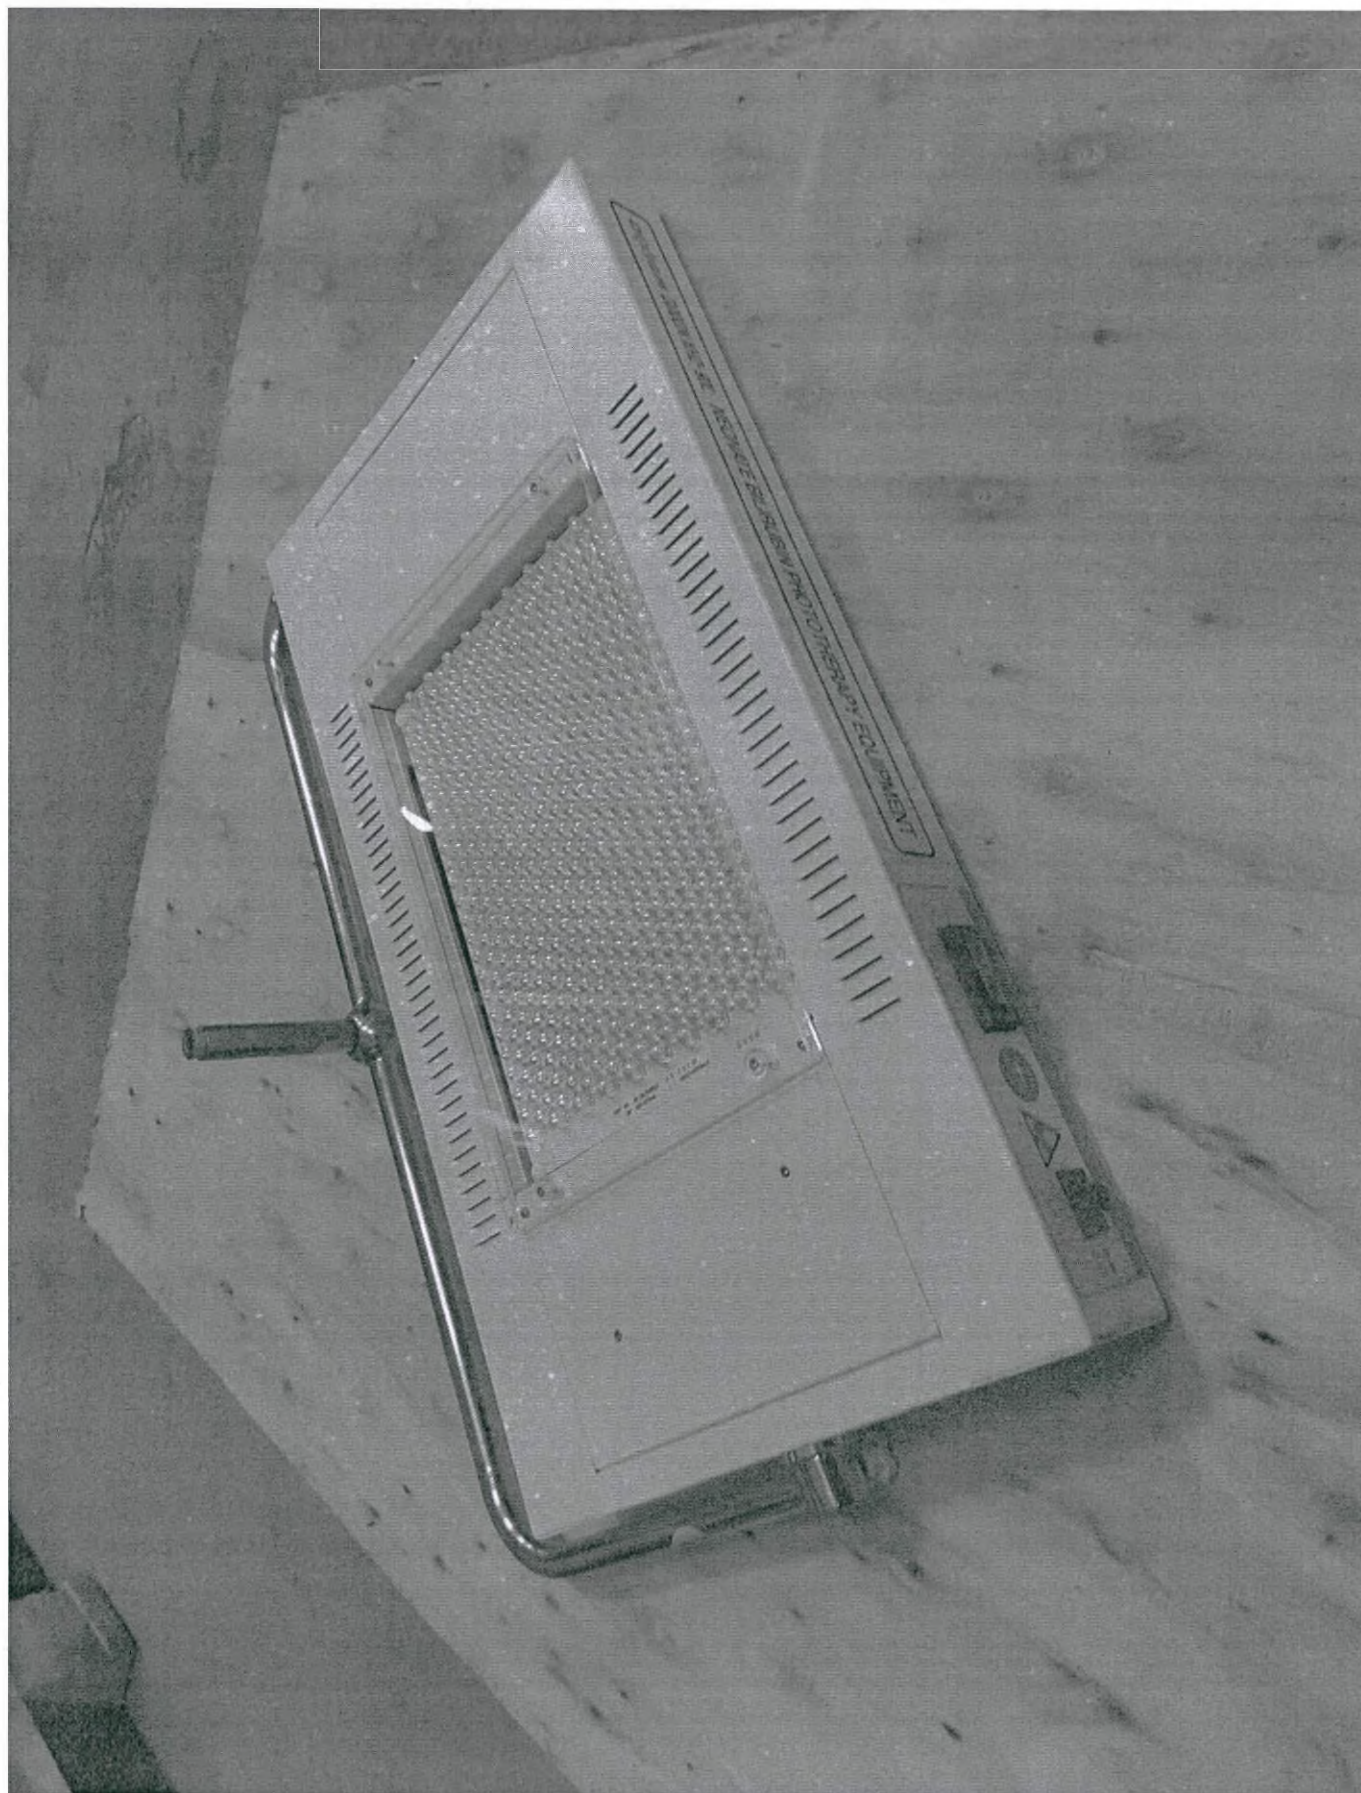


1.3 Основание мобильное

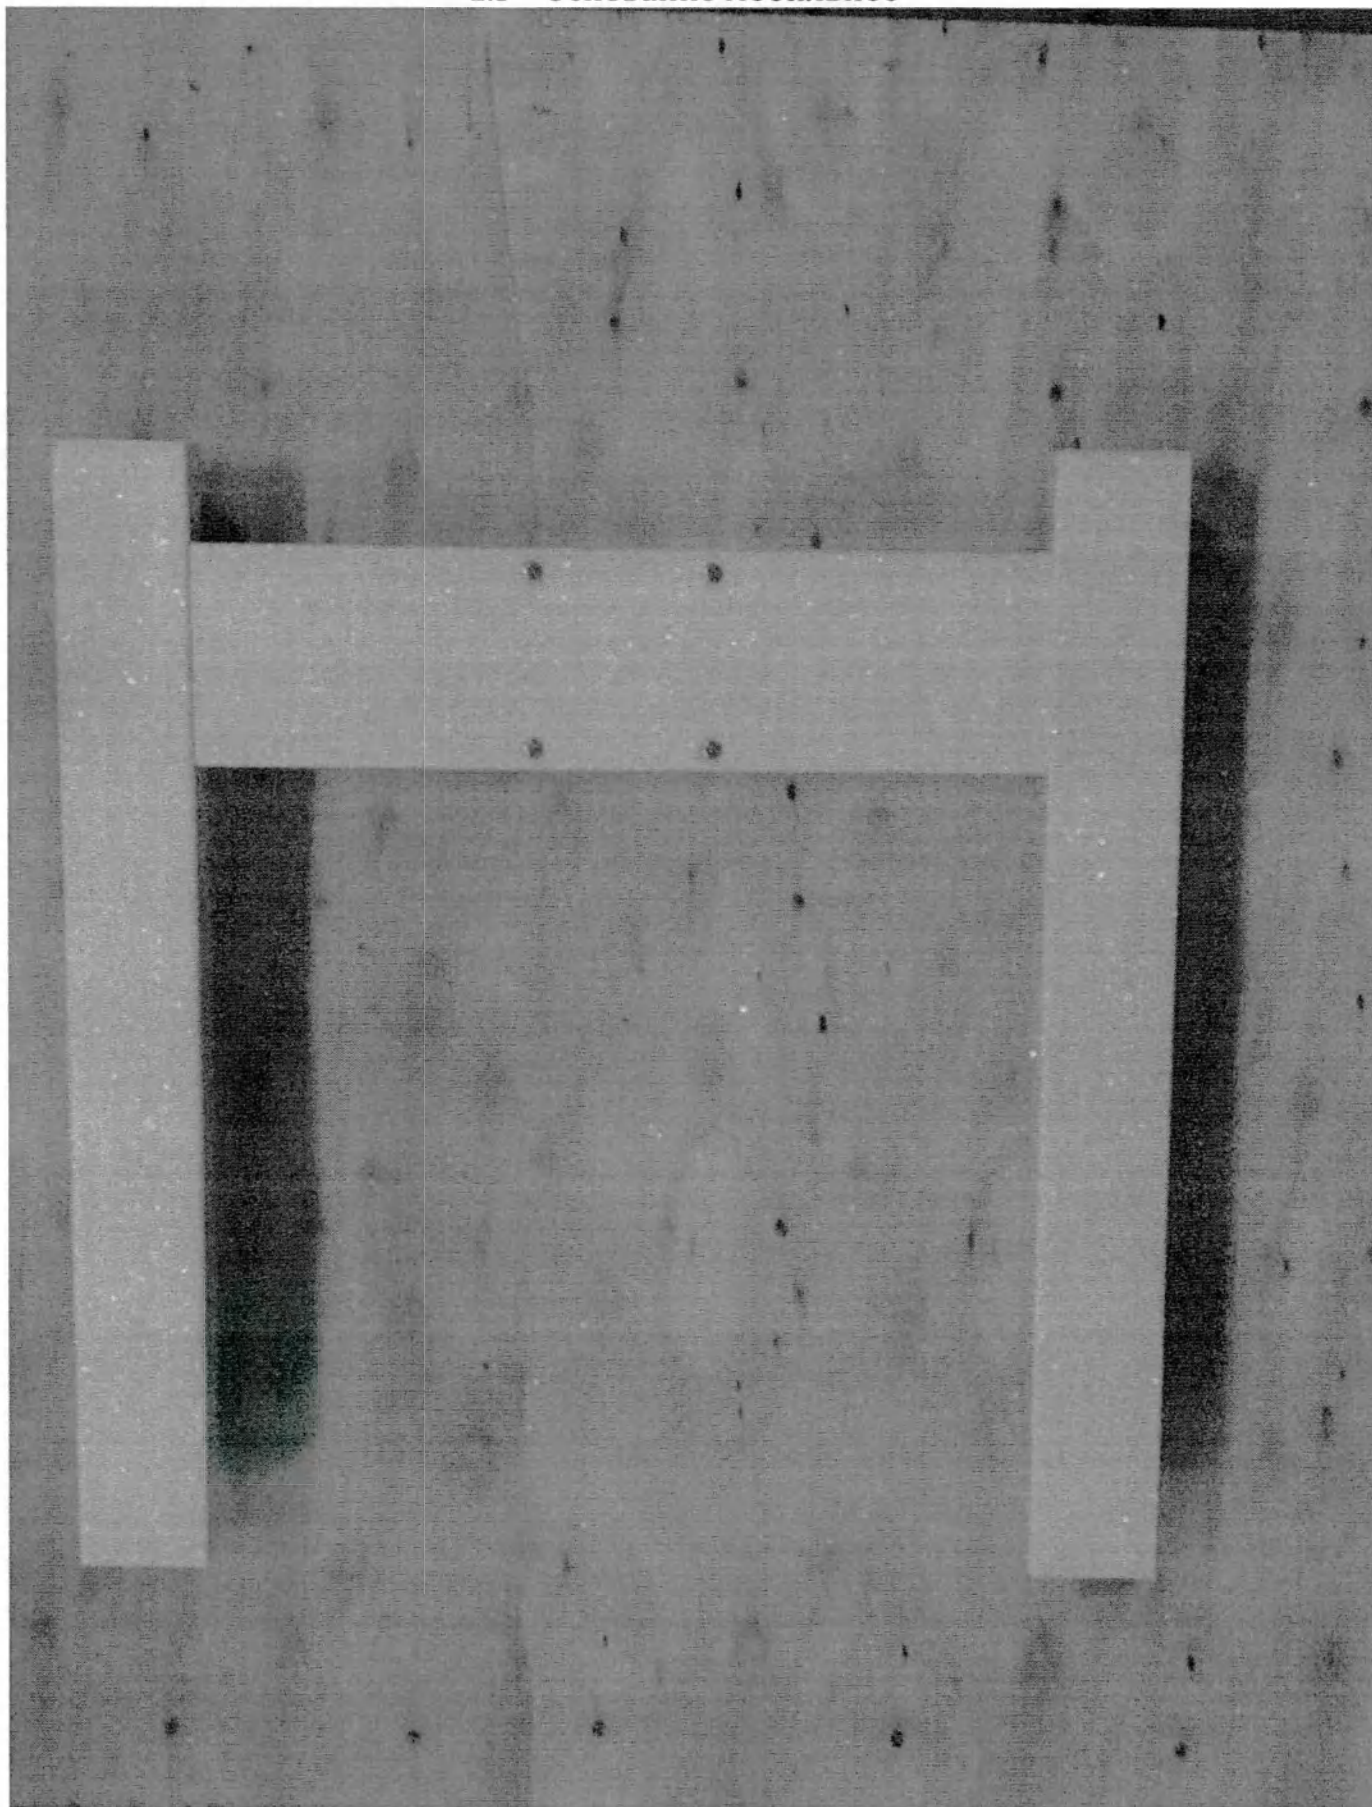


1.4 Стойка

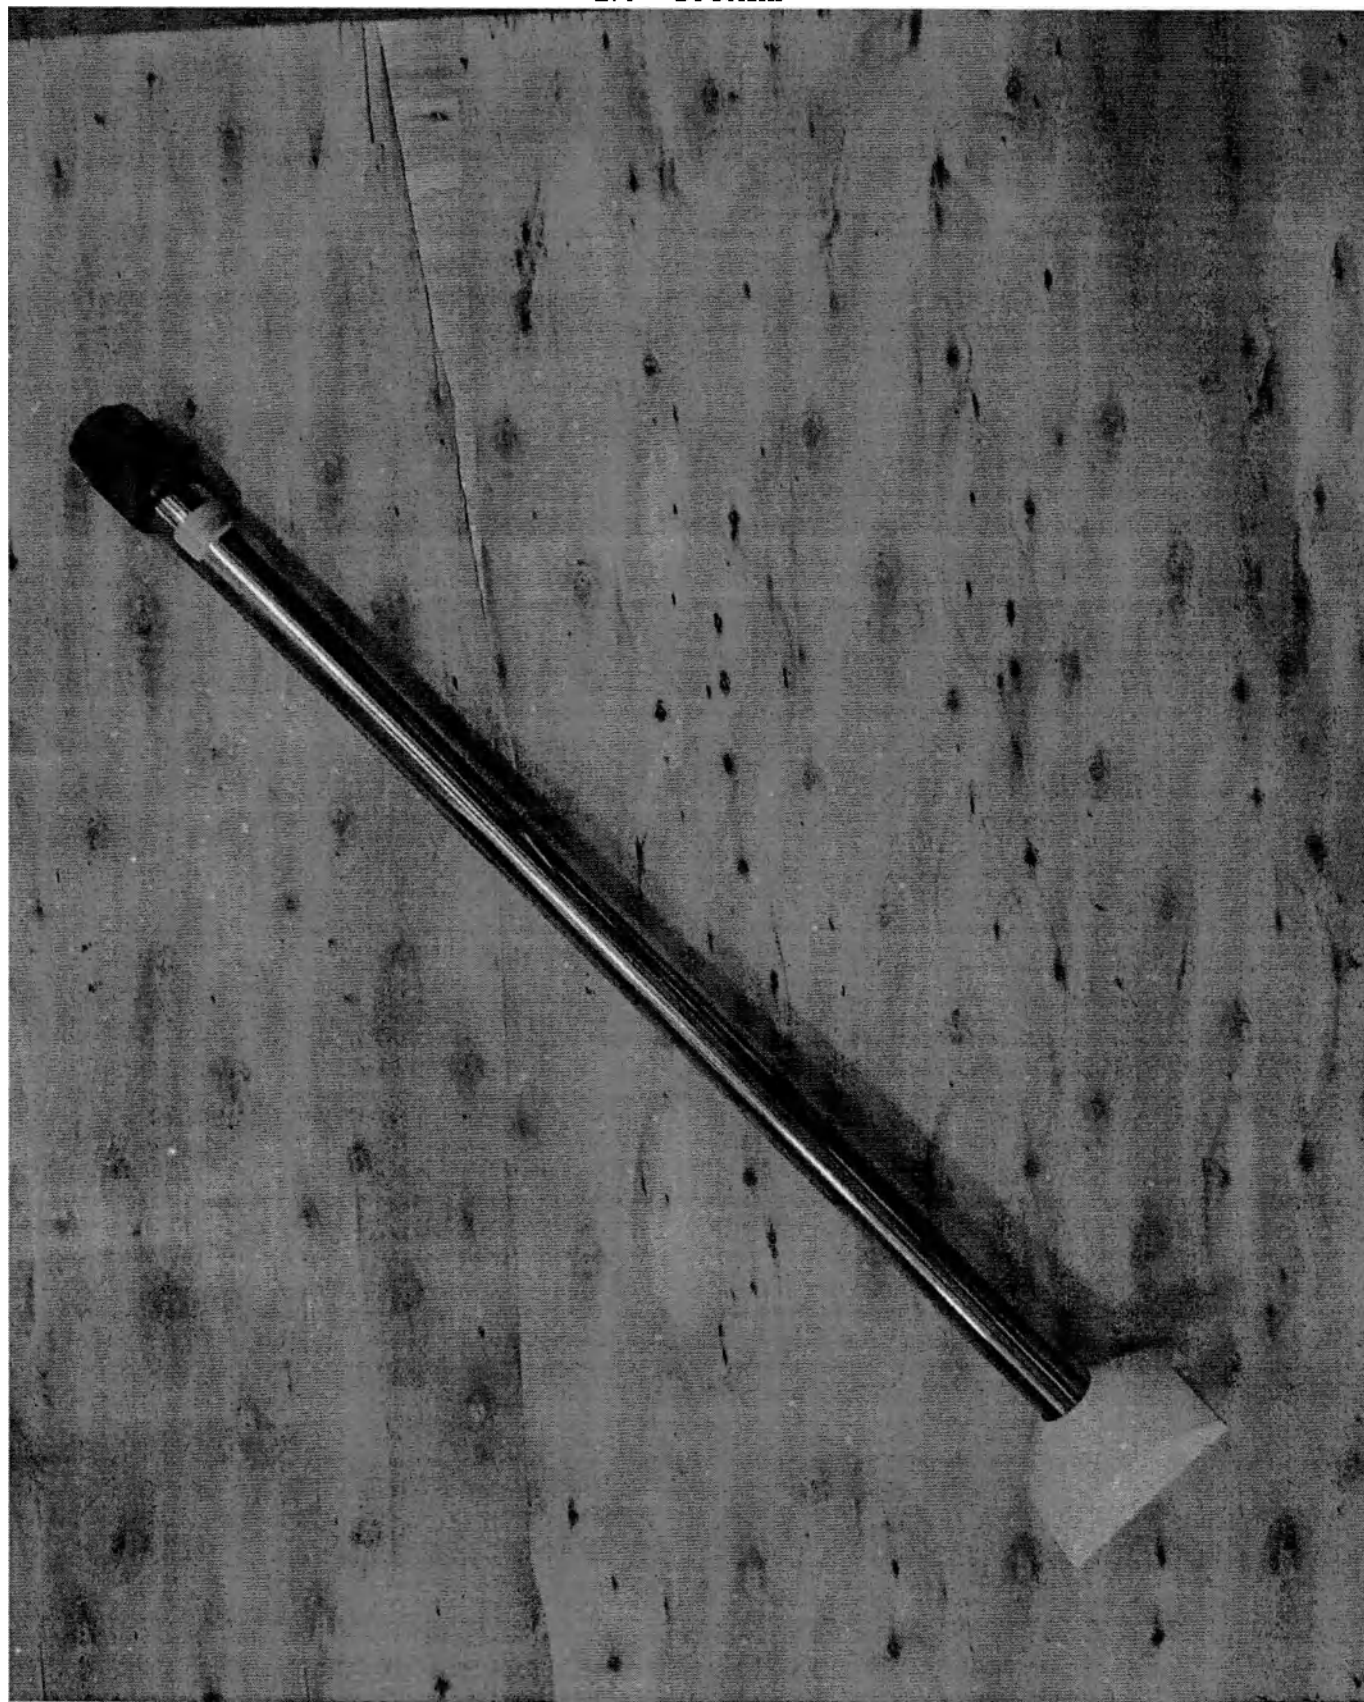


1.5 Стержень регулировки высоты

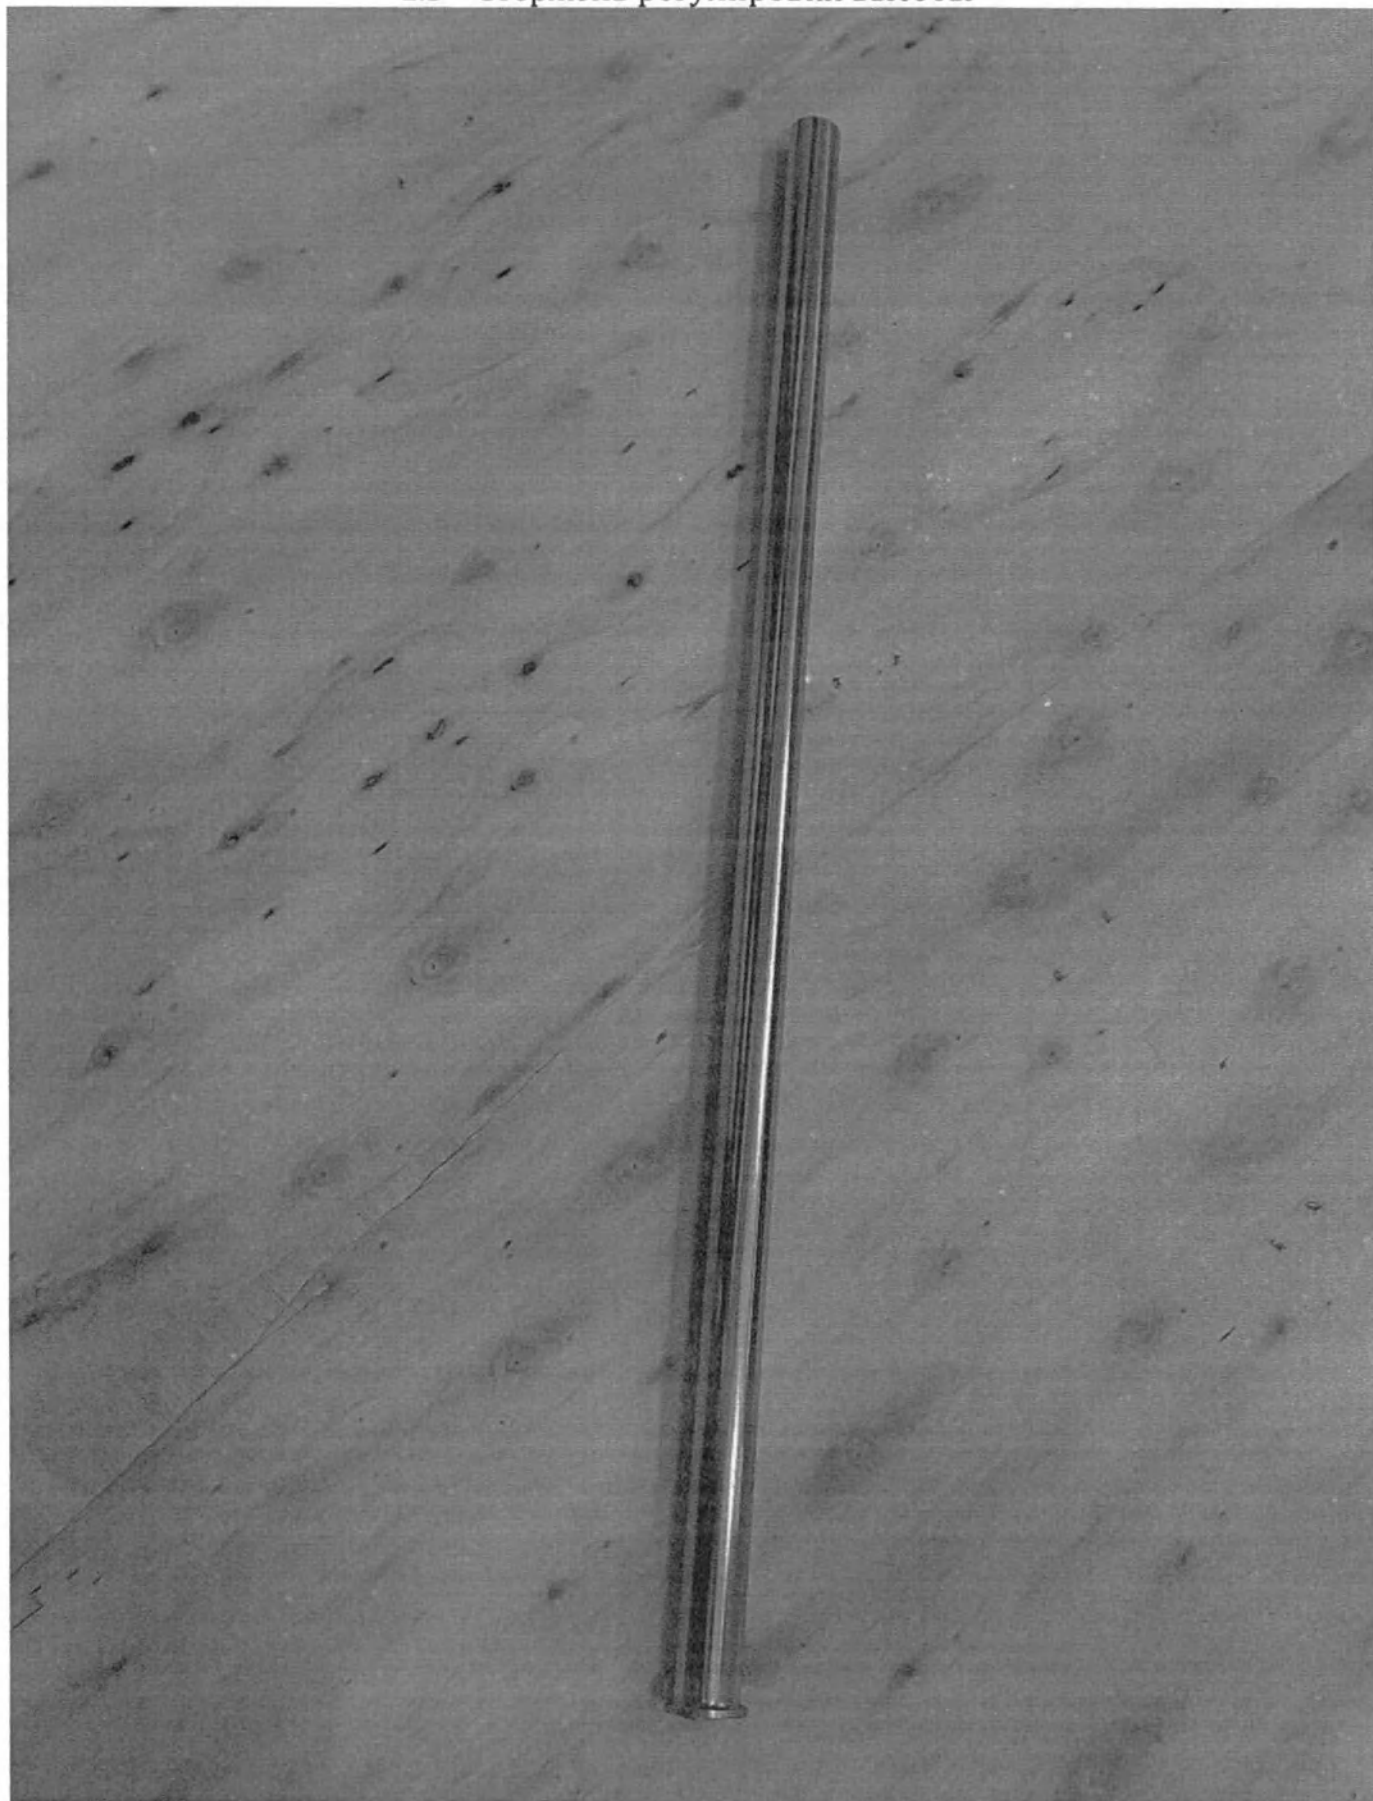


1.6 Кабель питания

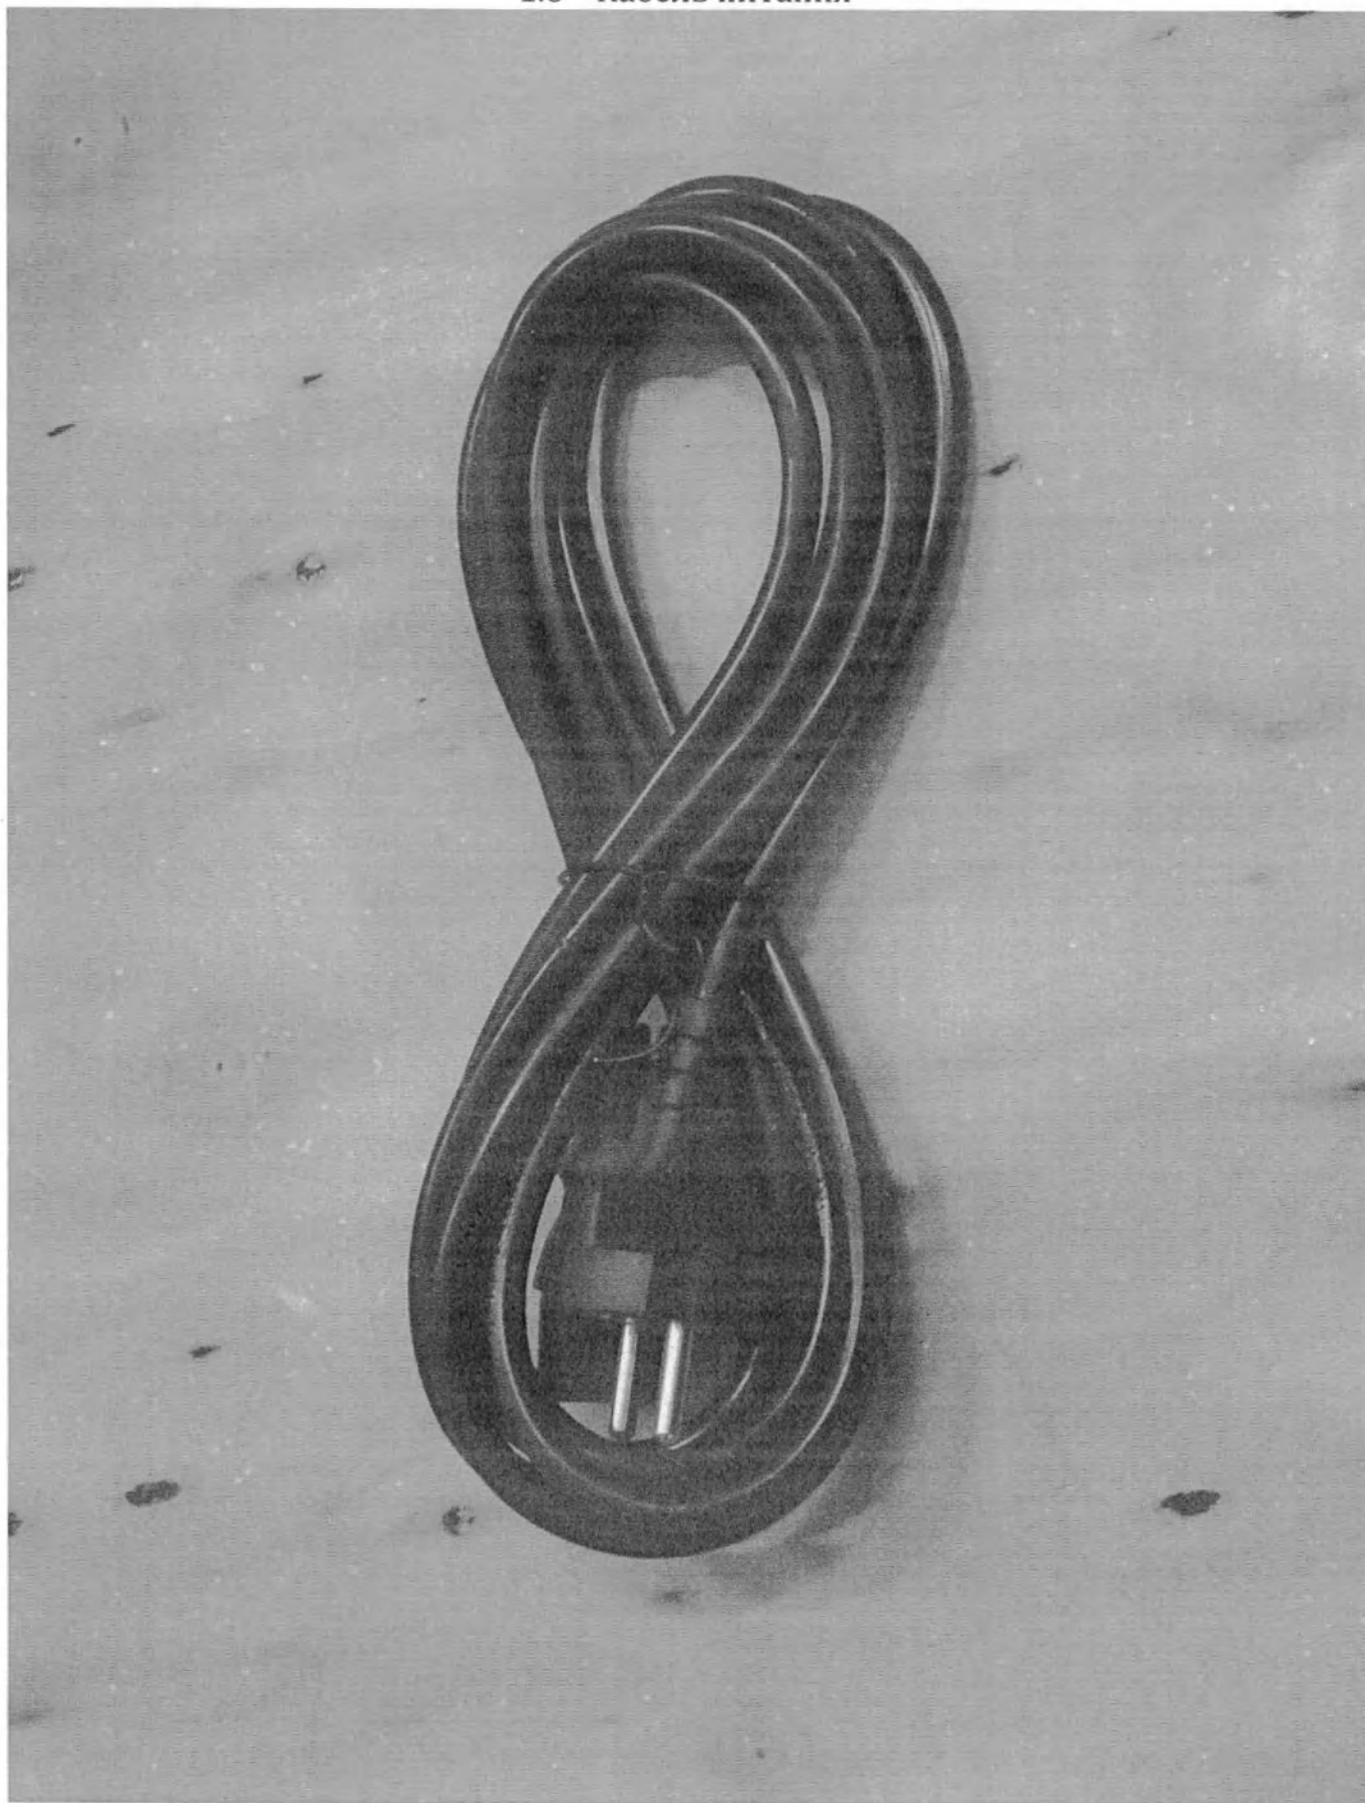

1.7 Предохранитель

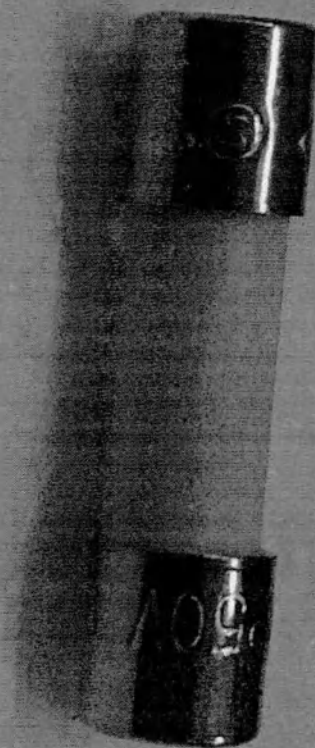


1.8 Пример маркировки аппарата

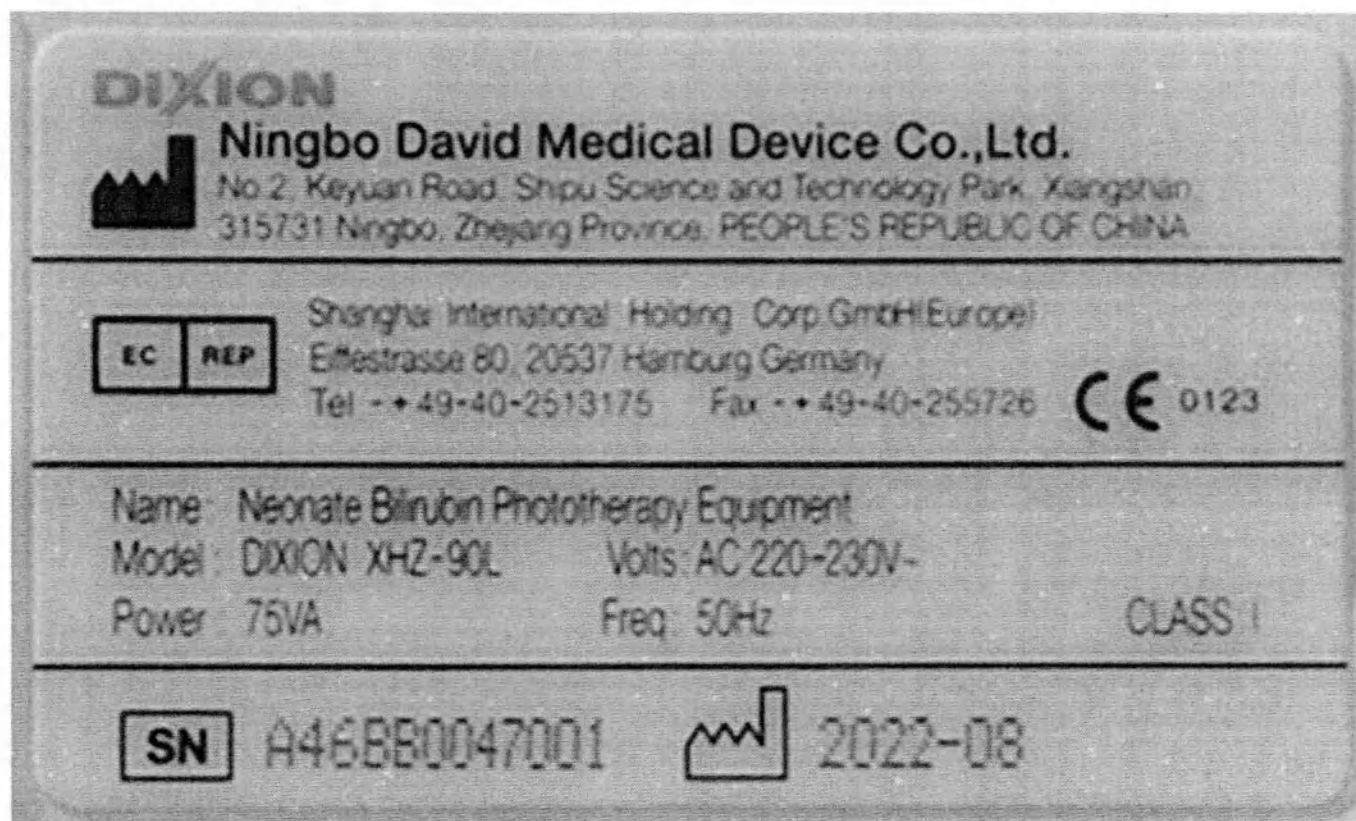


2 Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90P

2.1 Общий вид

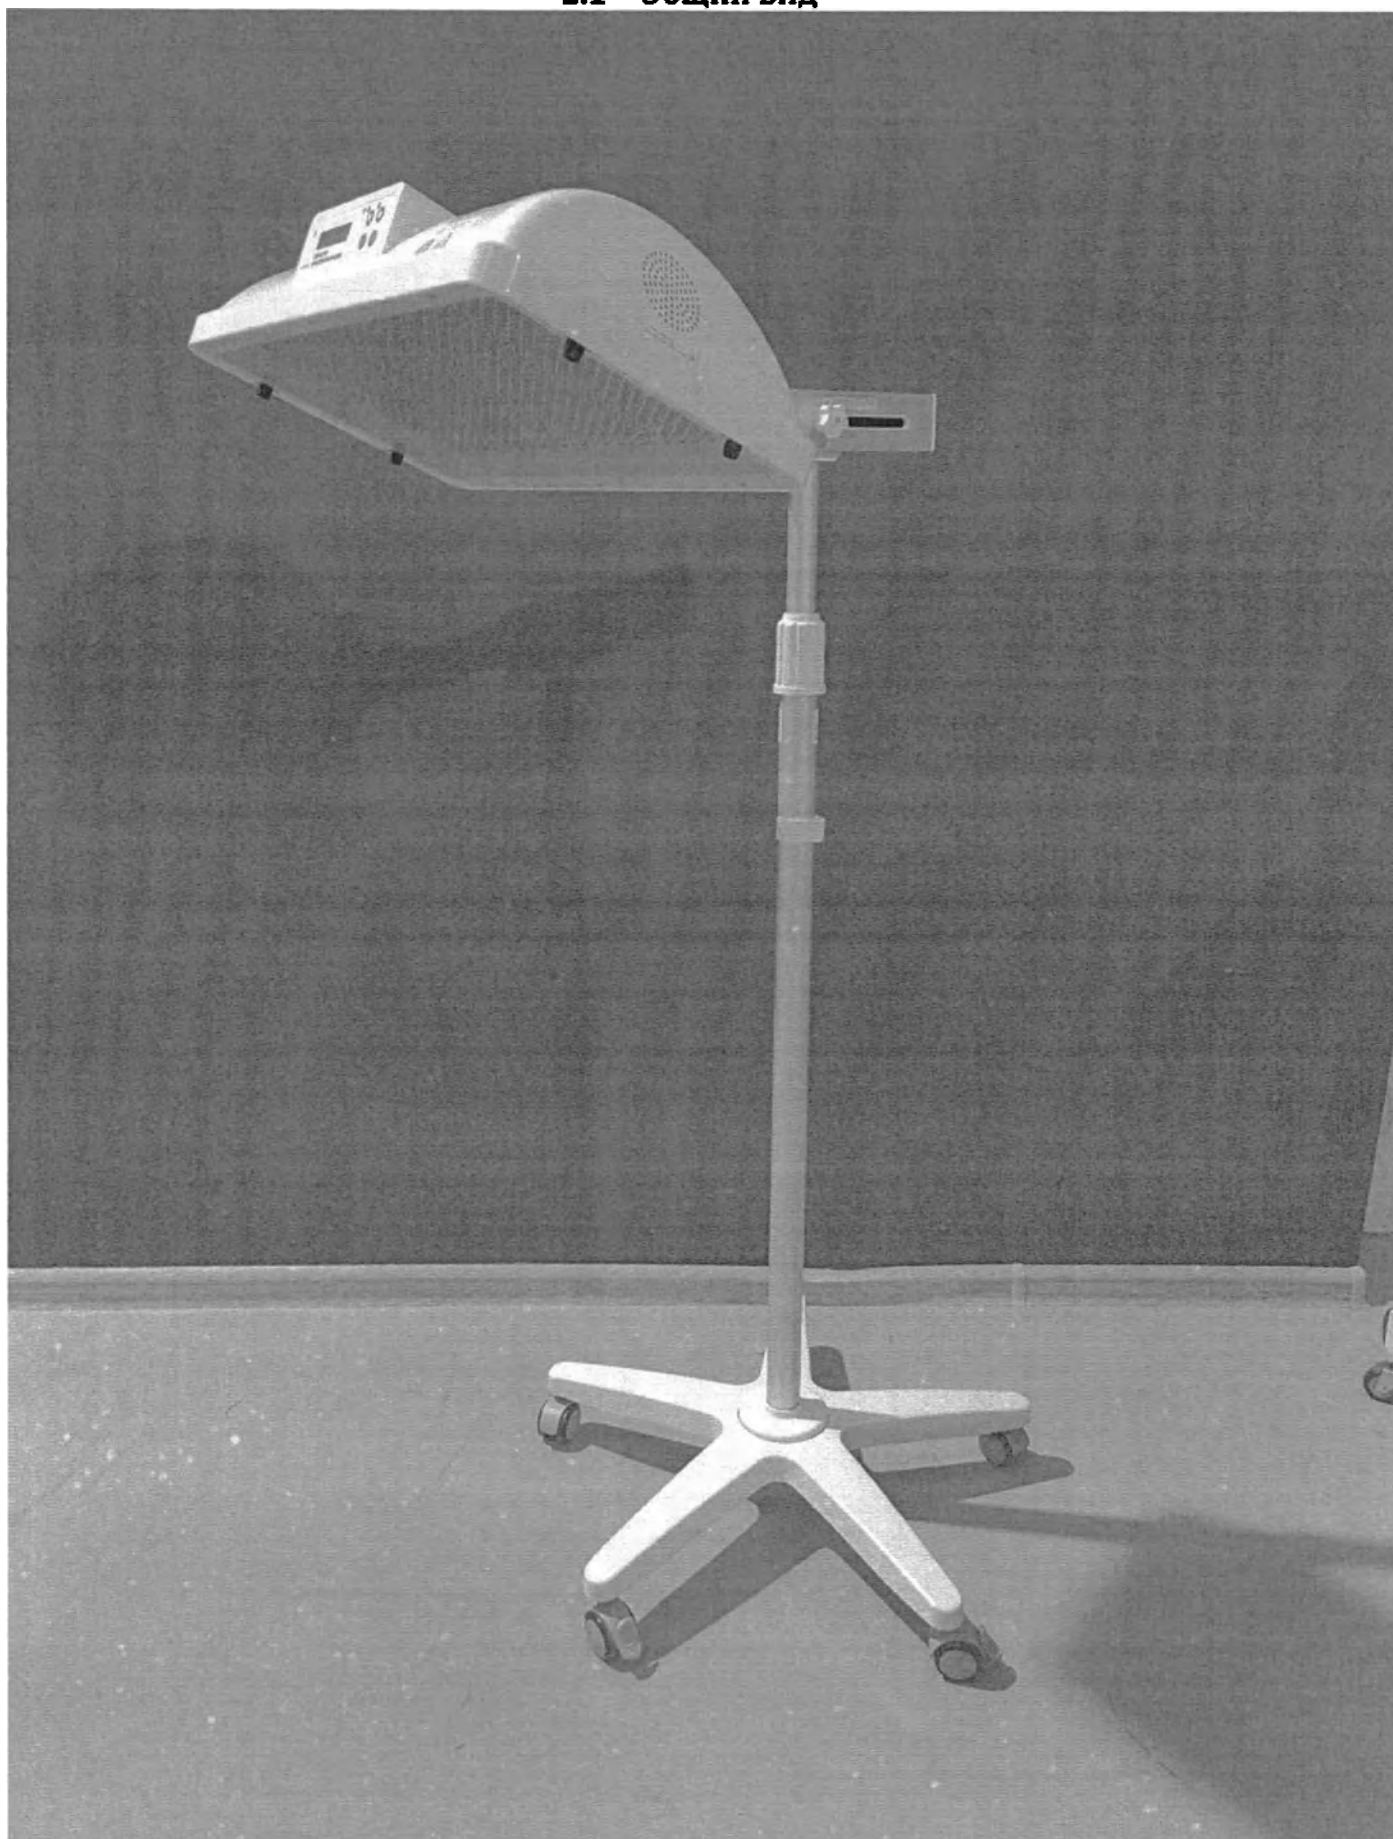

2.2 Основной блок

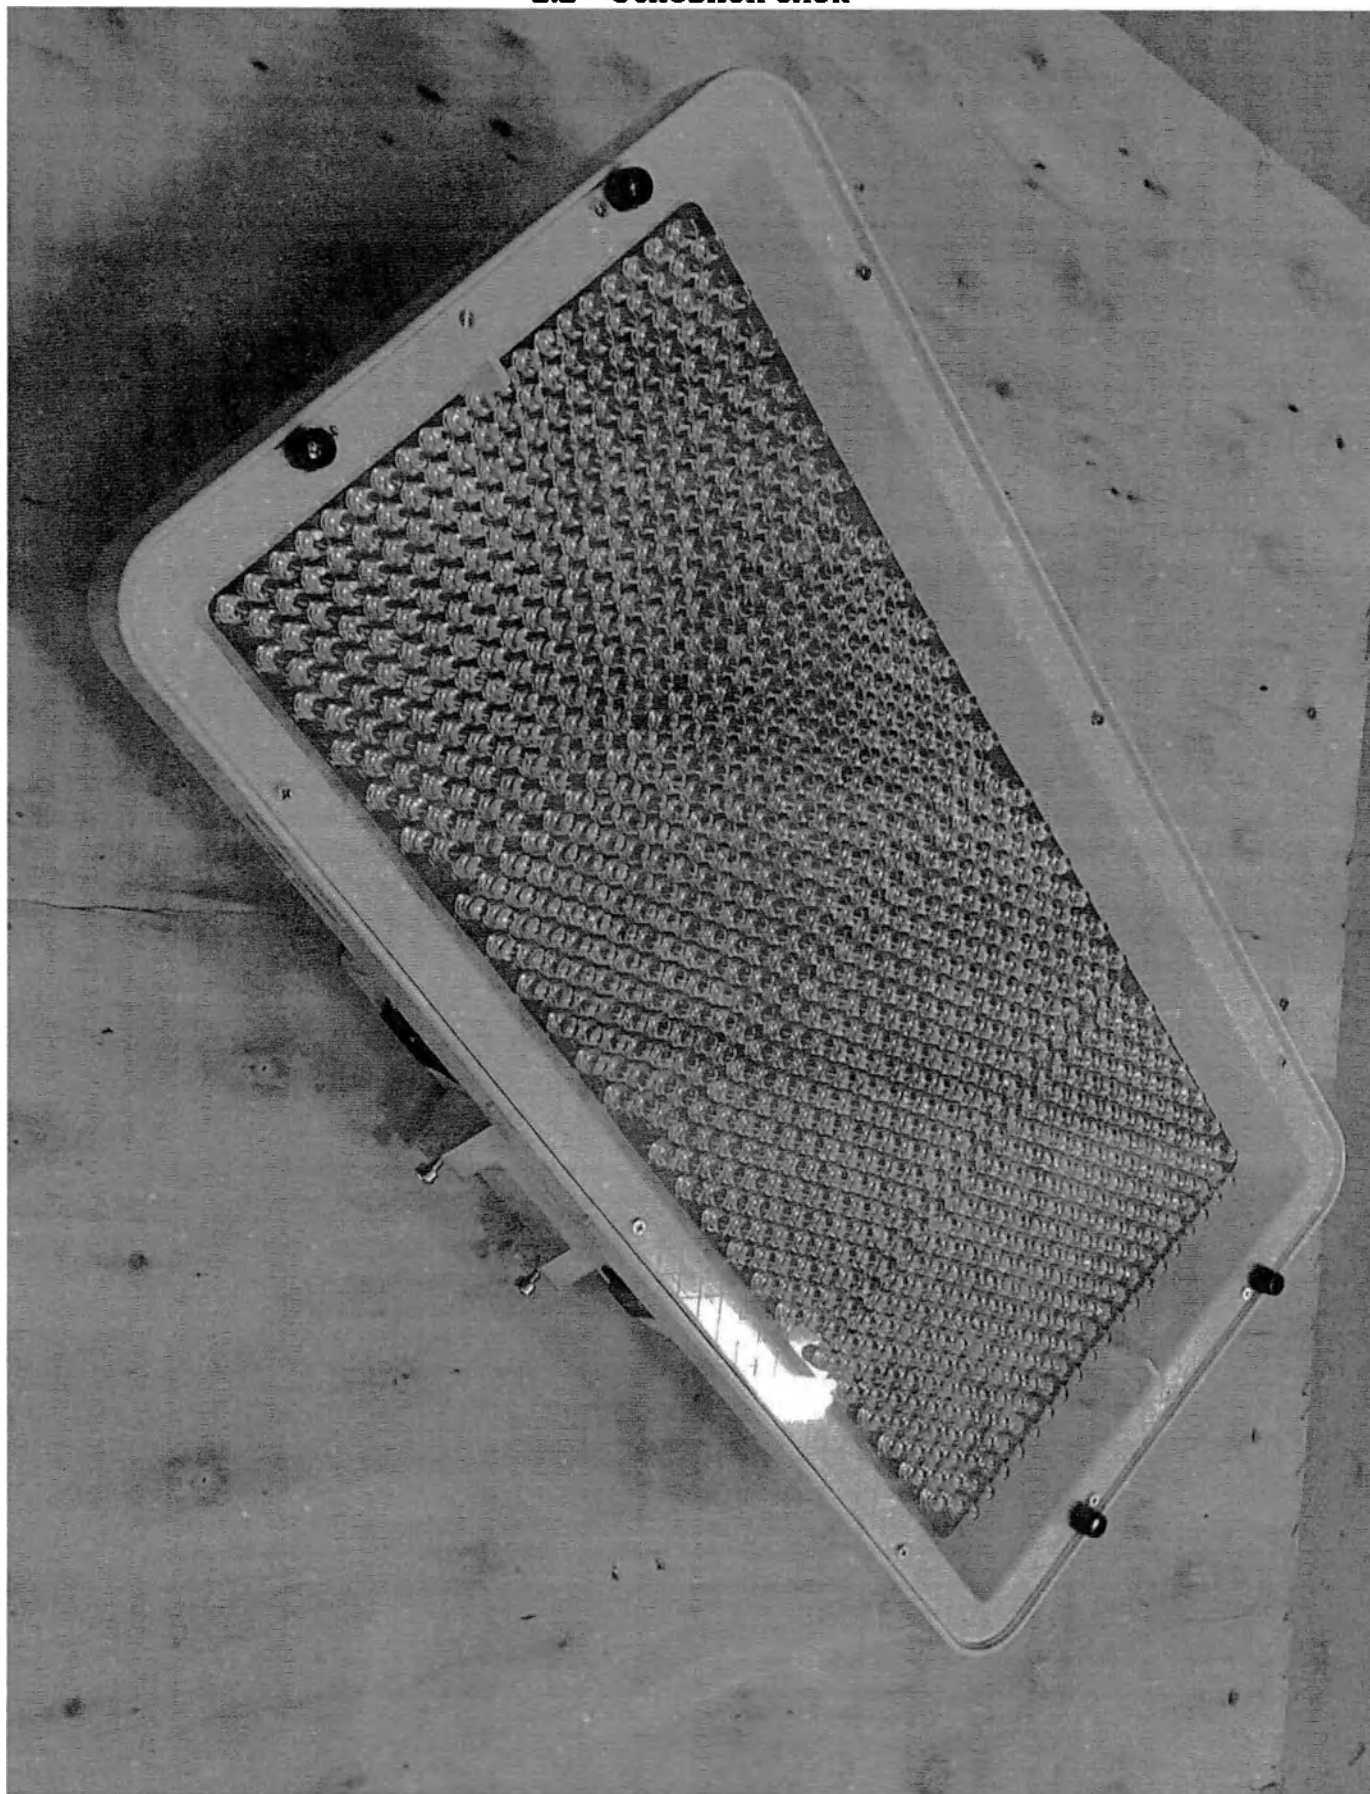


2.3 Основание мобильное




2.4 Стойка с регулировкой высоты



2.5 Кабель питания

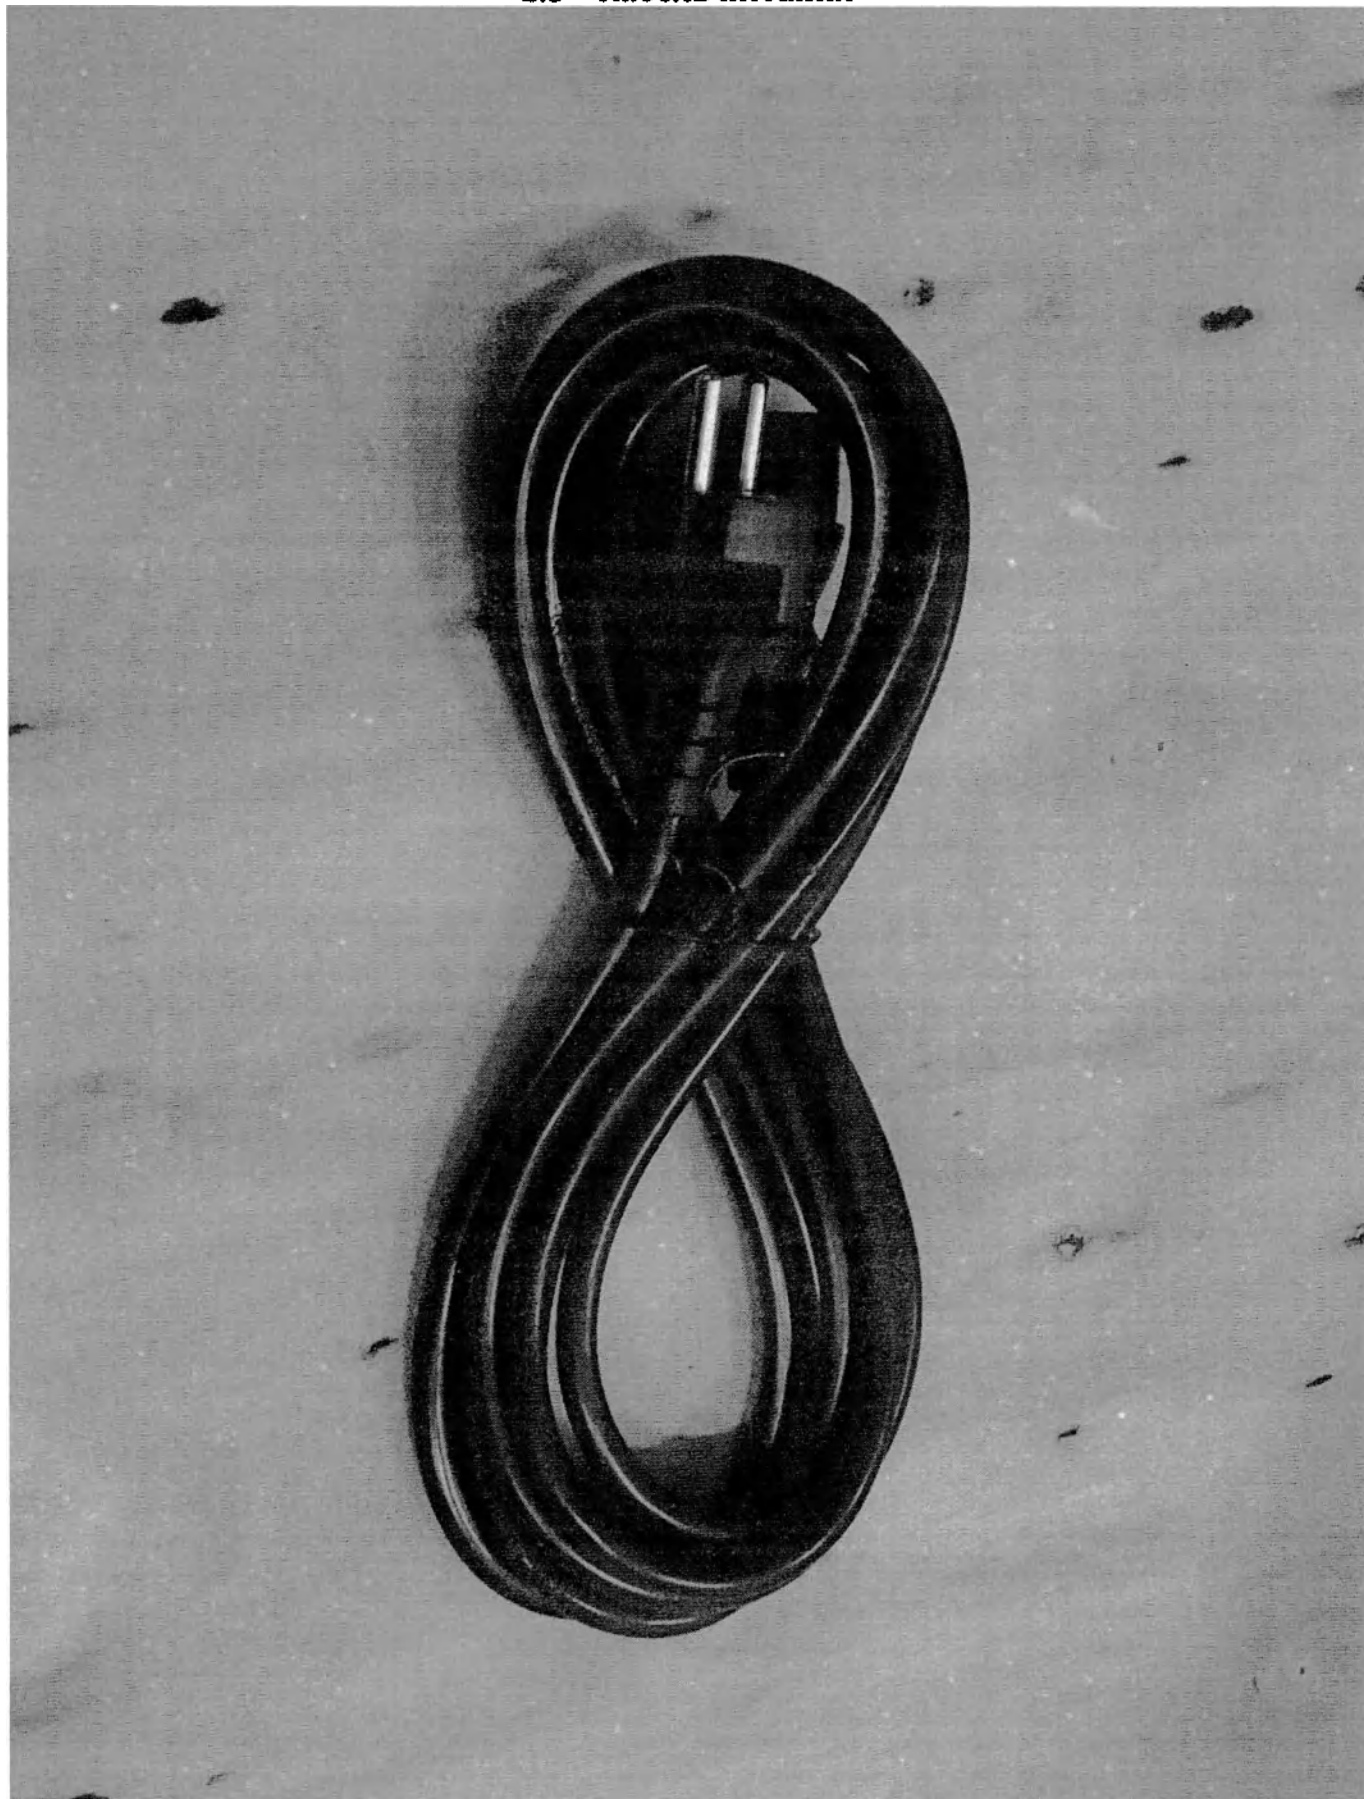

2.6 Предохранитель

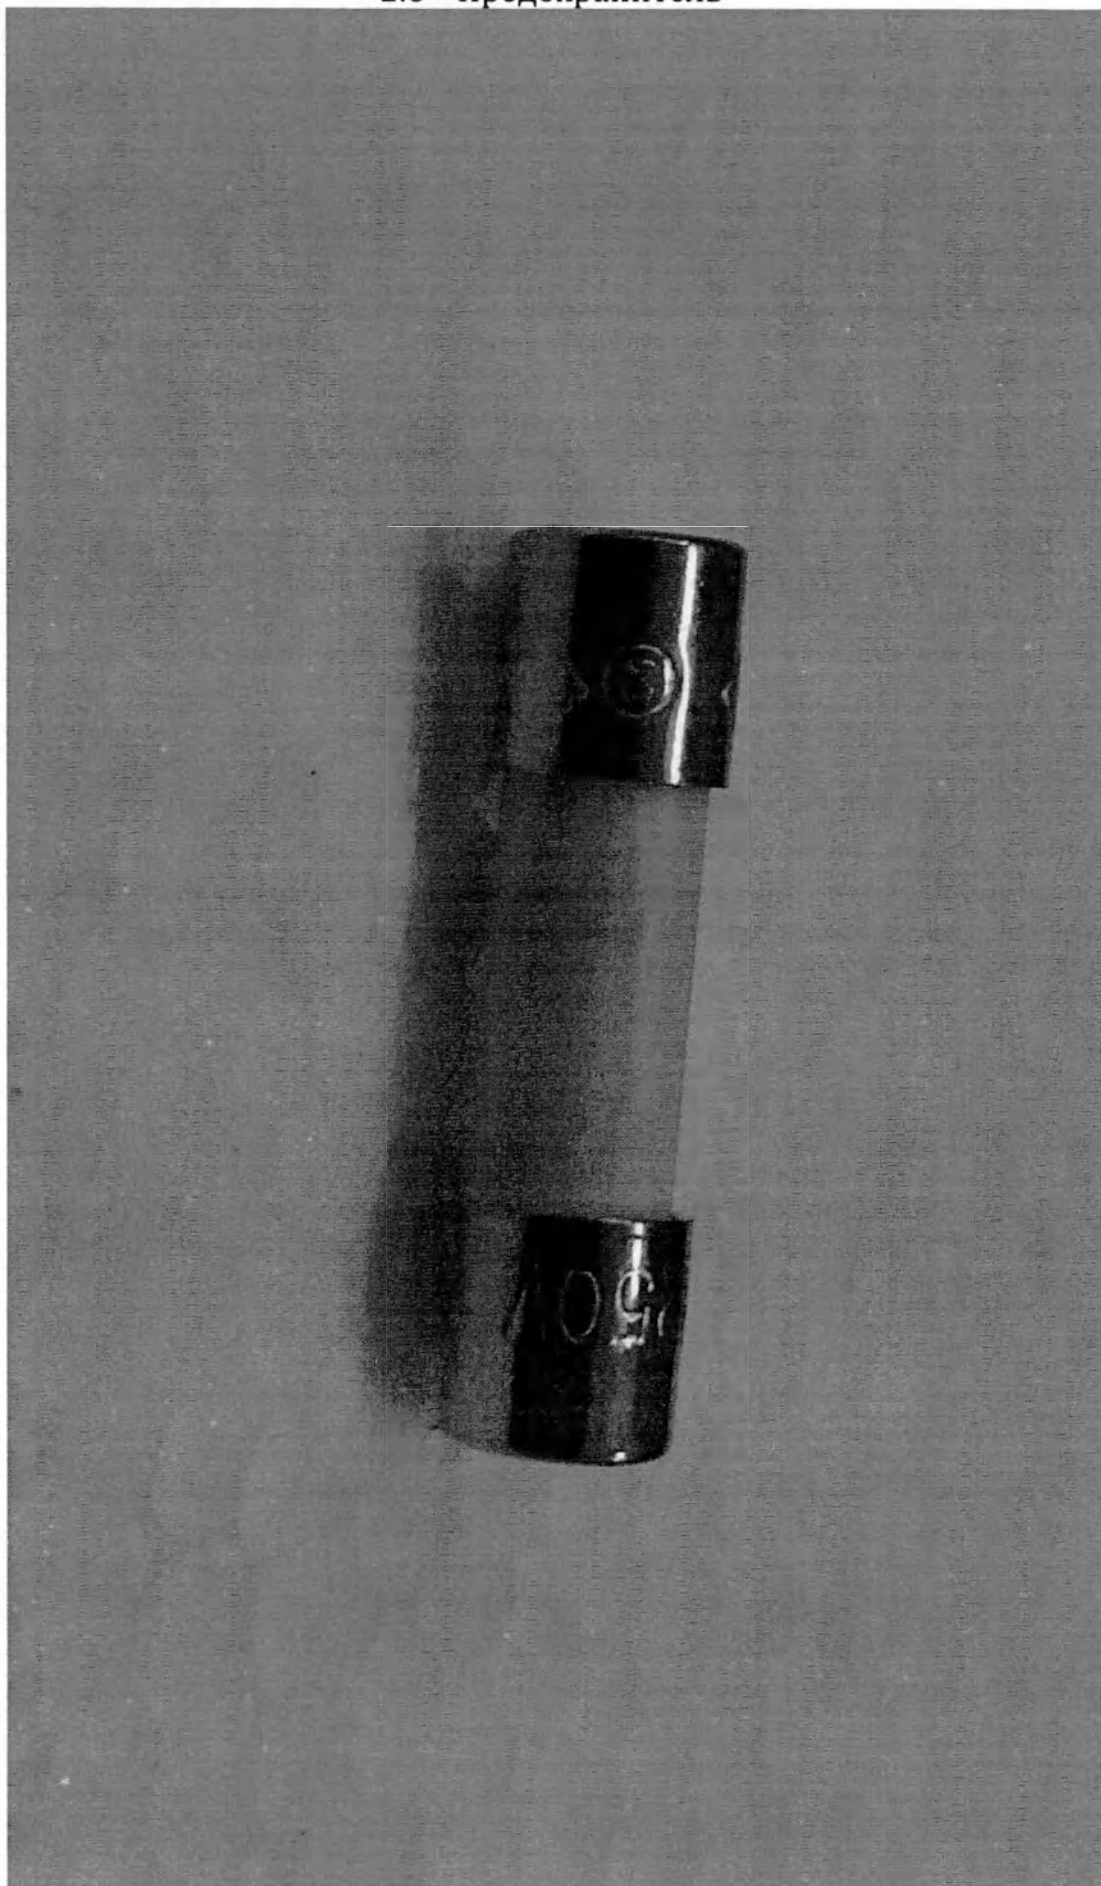


2.7 Пример маркировки аппарата



3 Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90Q

3.1 Общий вид

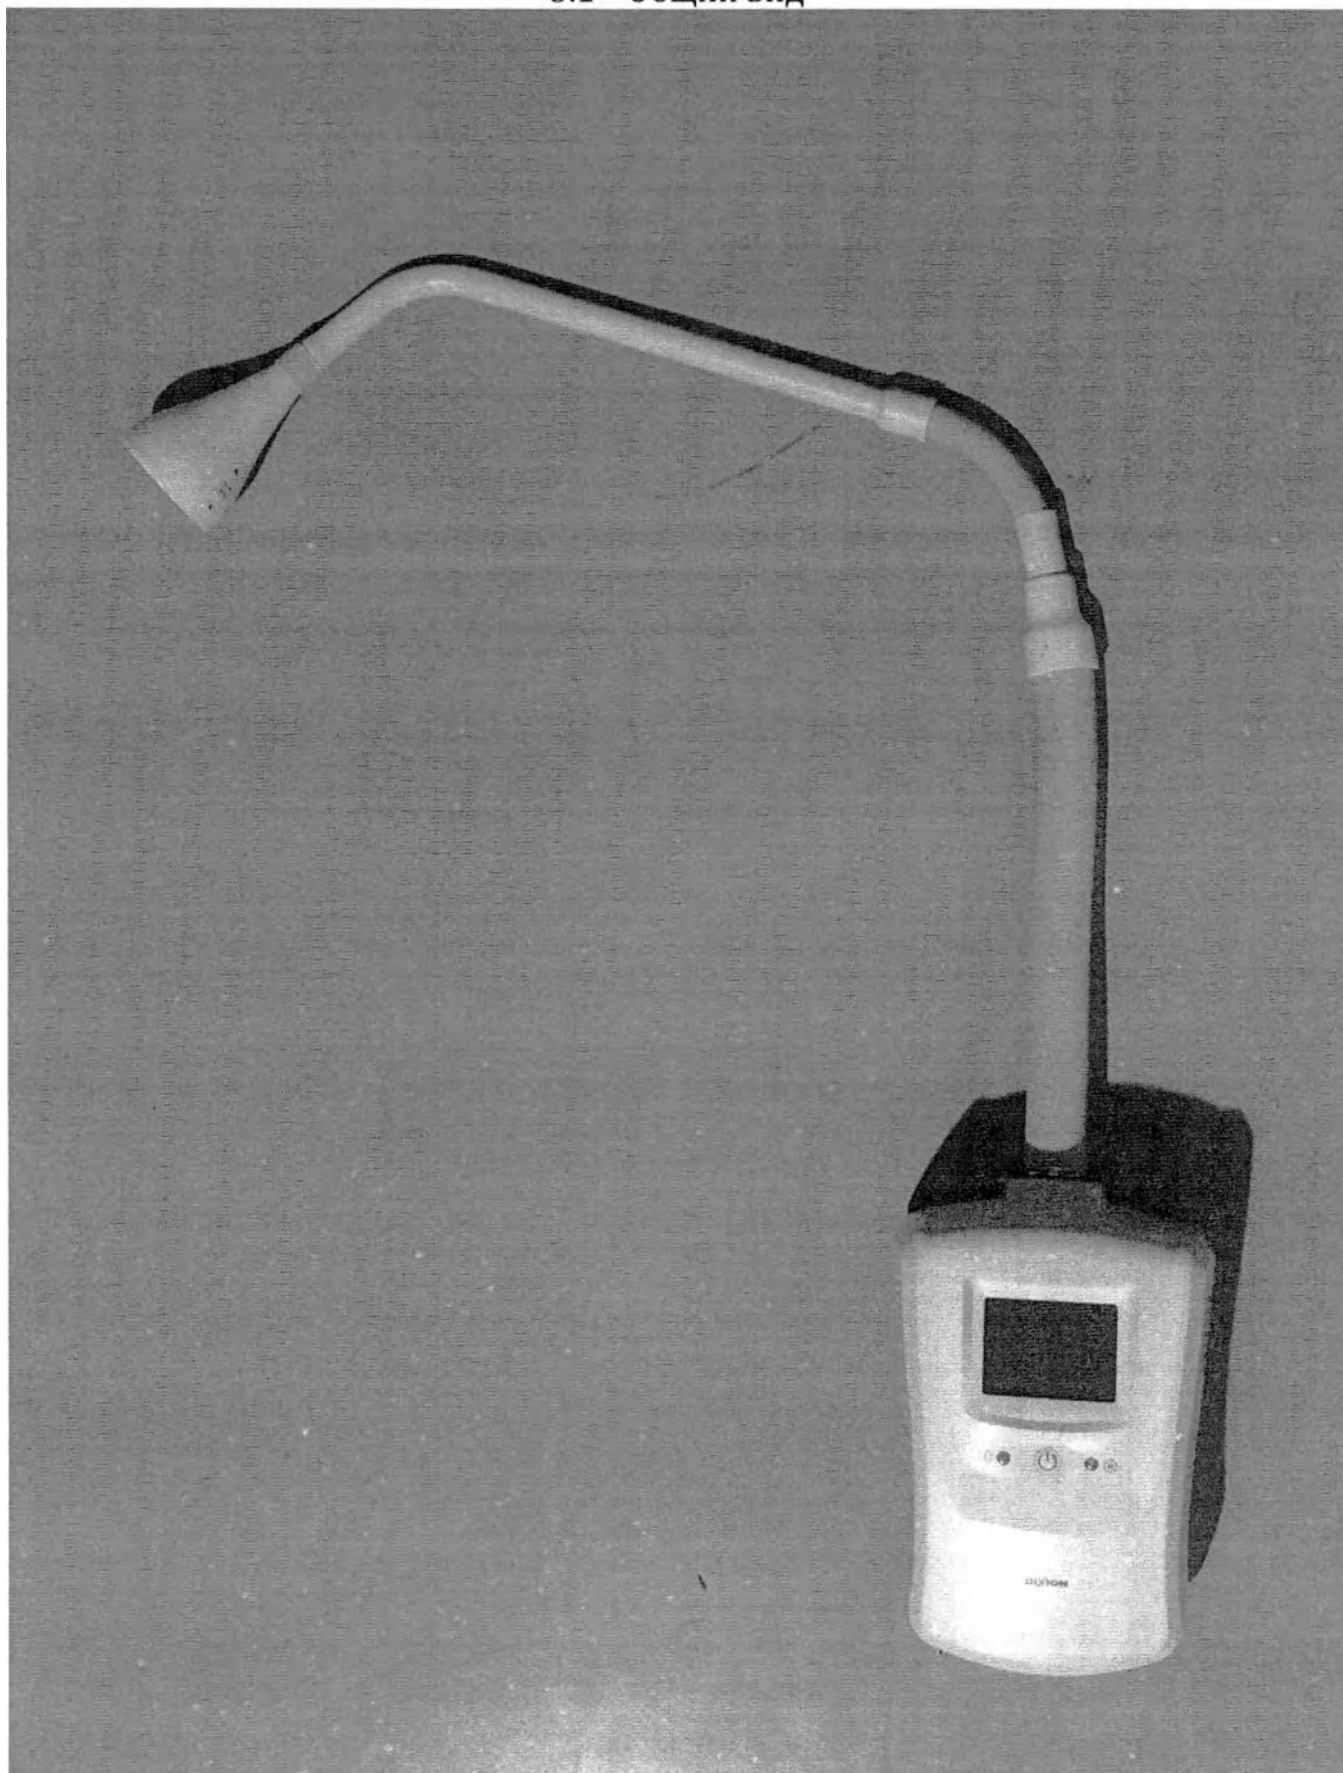


3.2 Основной блок




3.3 Световод




3.4 Кабель питания

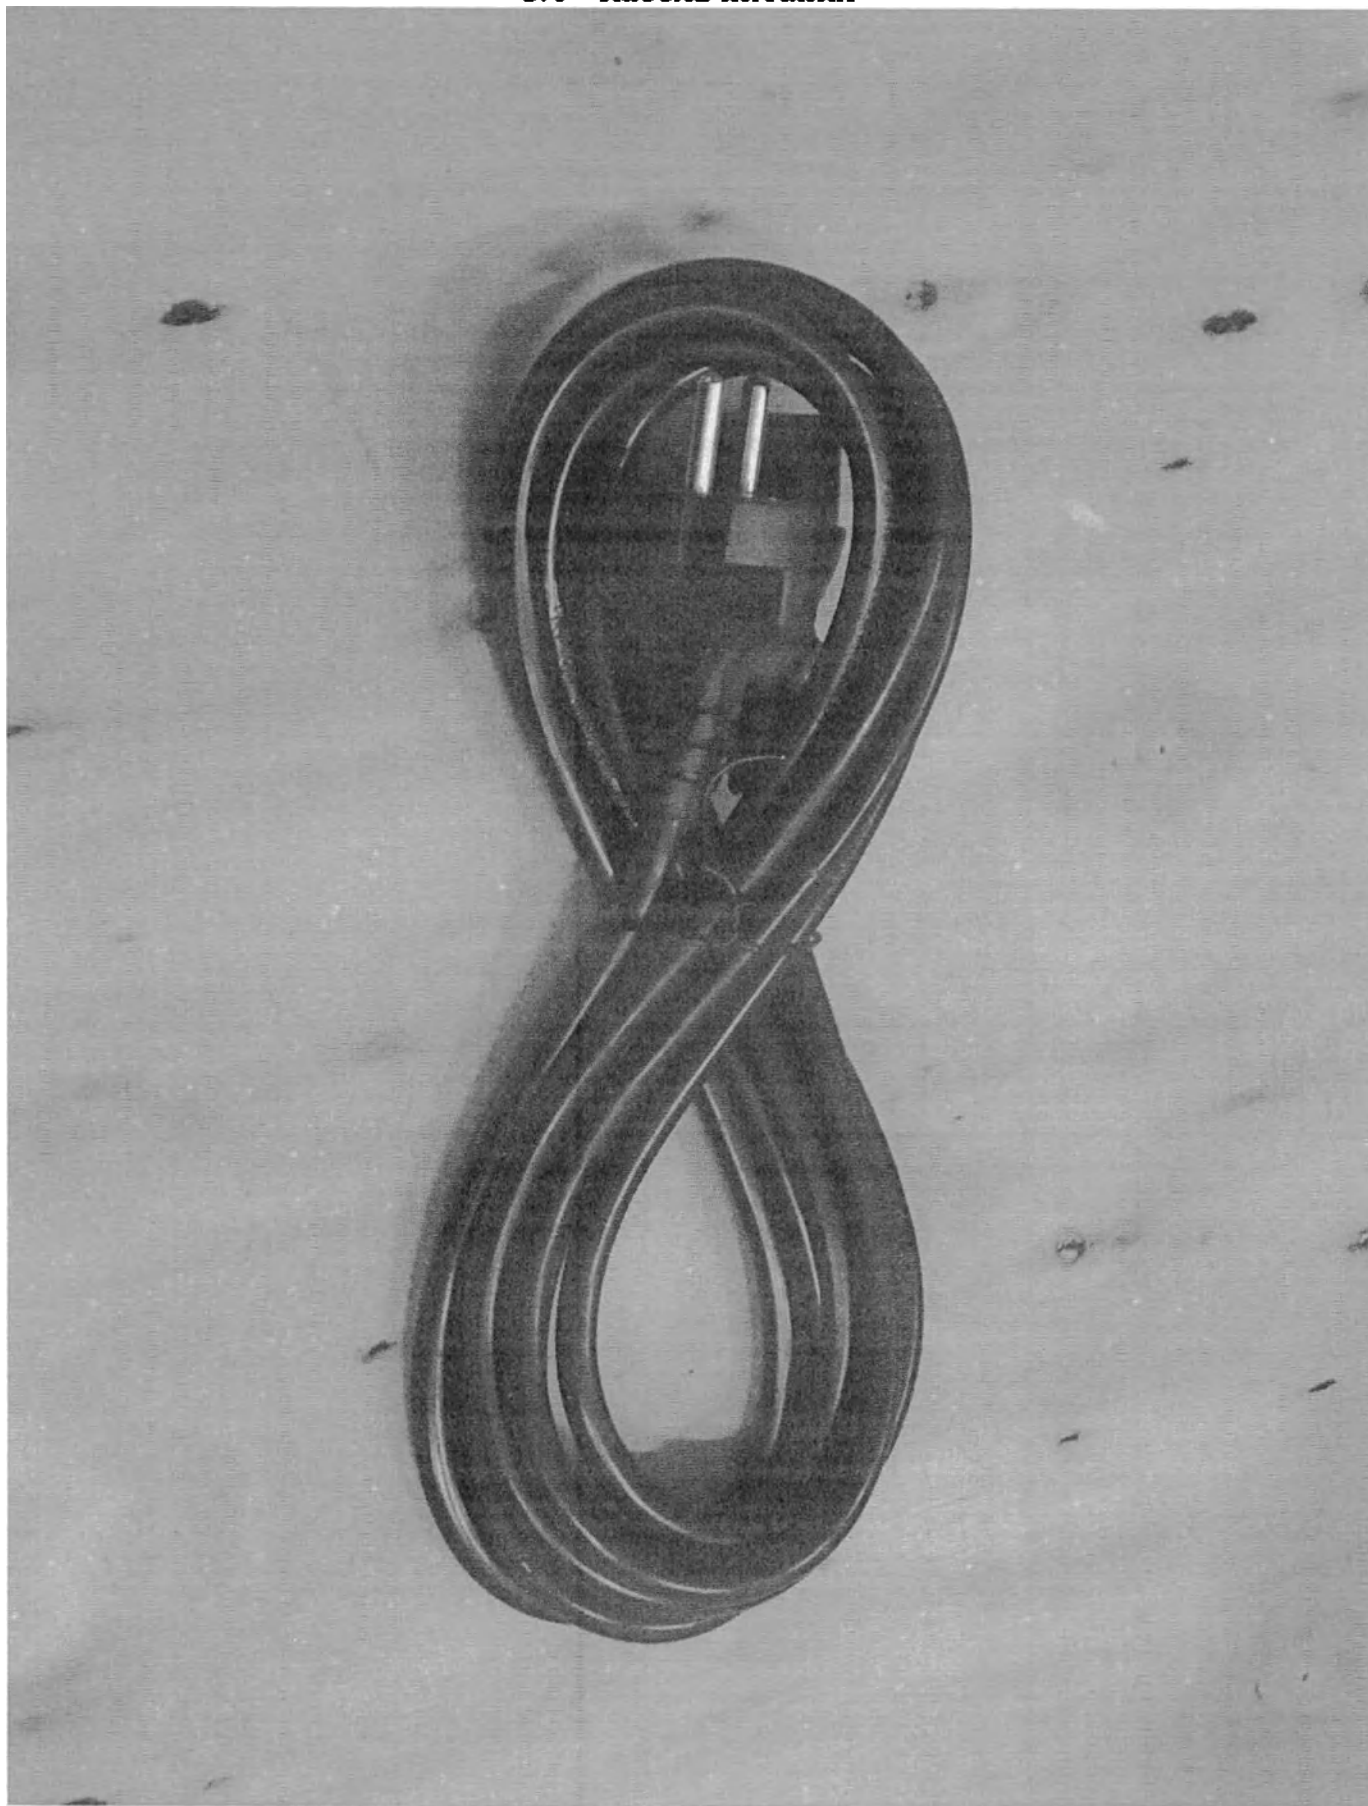

3.5 Предохранитель

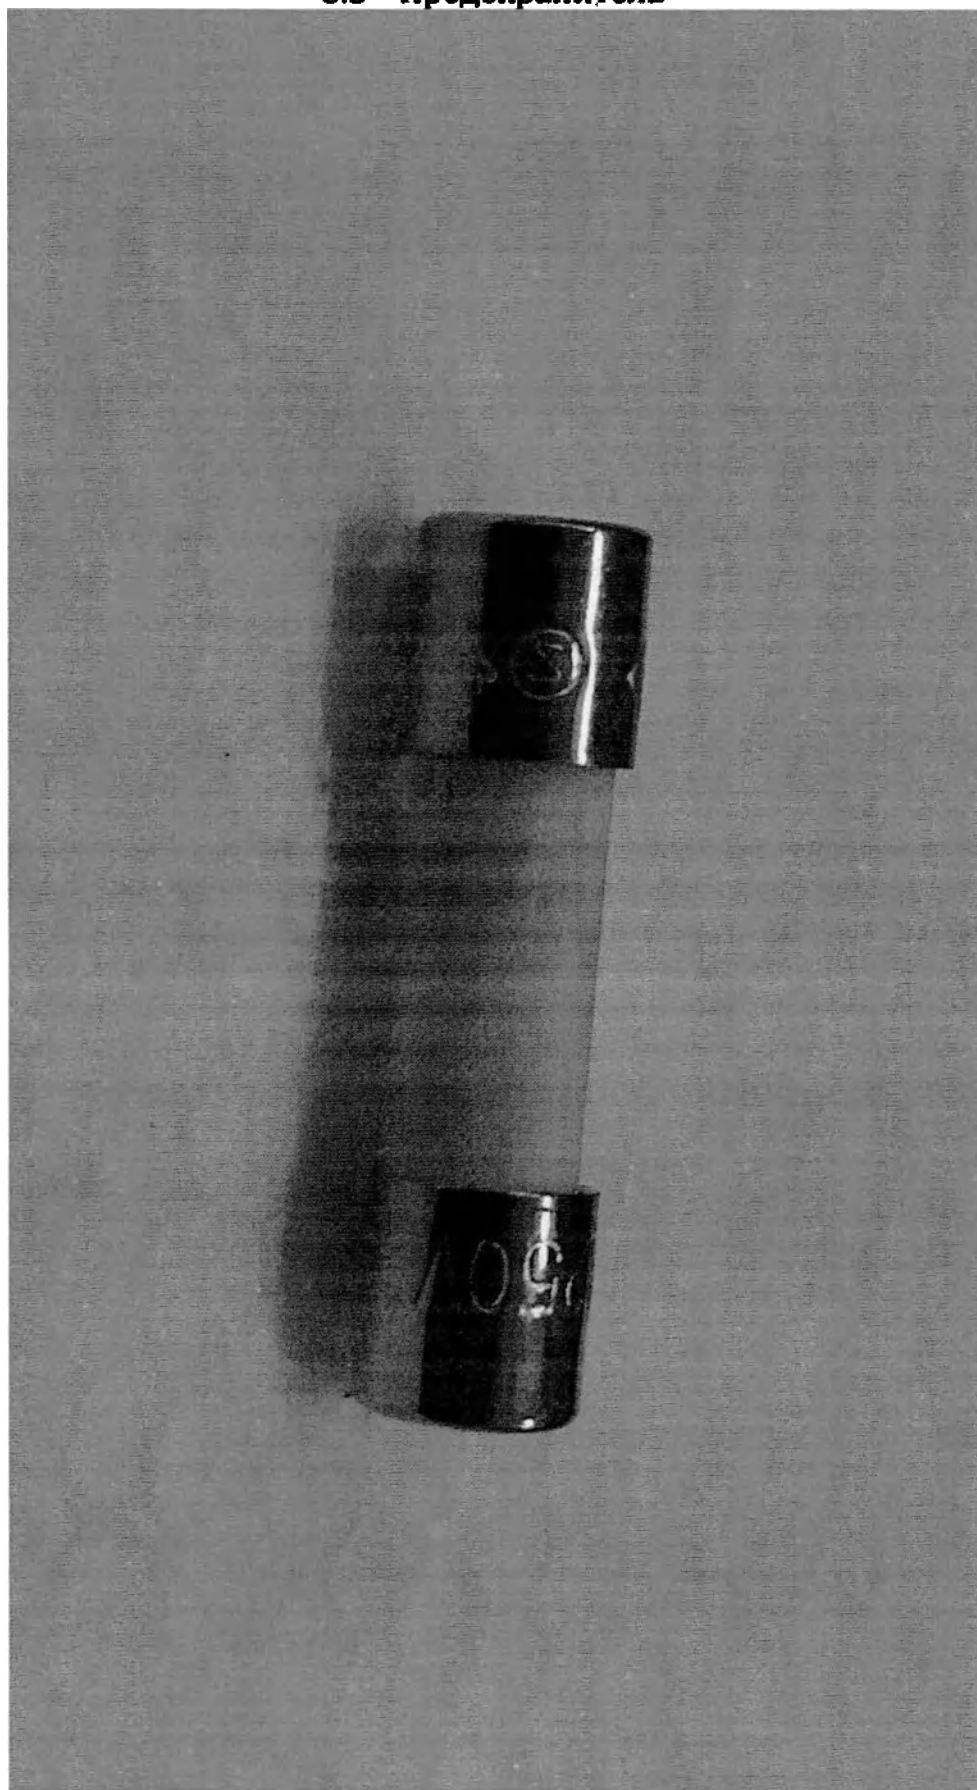

3.6 Пример маркировки аппарата

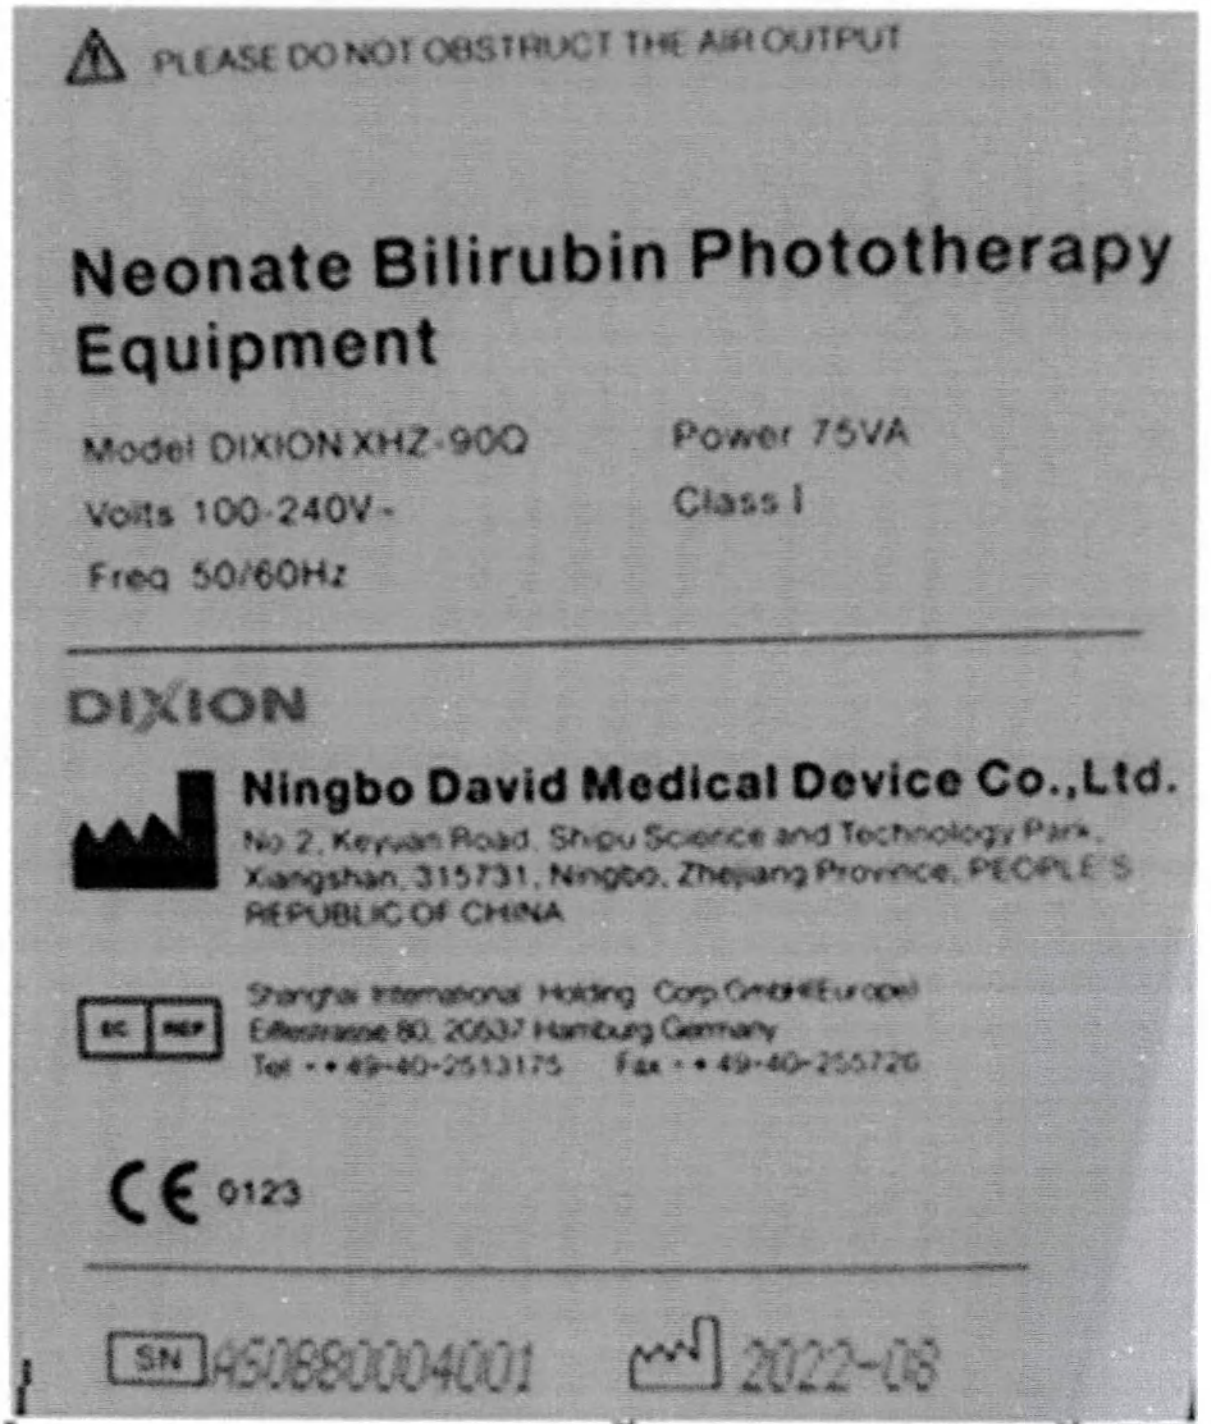


4 Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-90S


4.1 Общий вид




4.2 Основной блок в сборе с кабелем питания

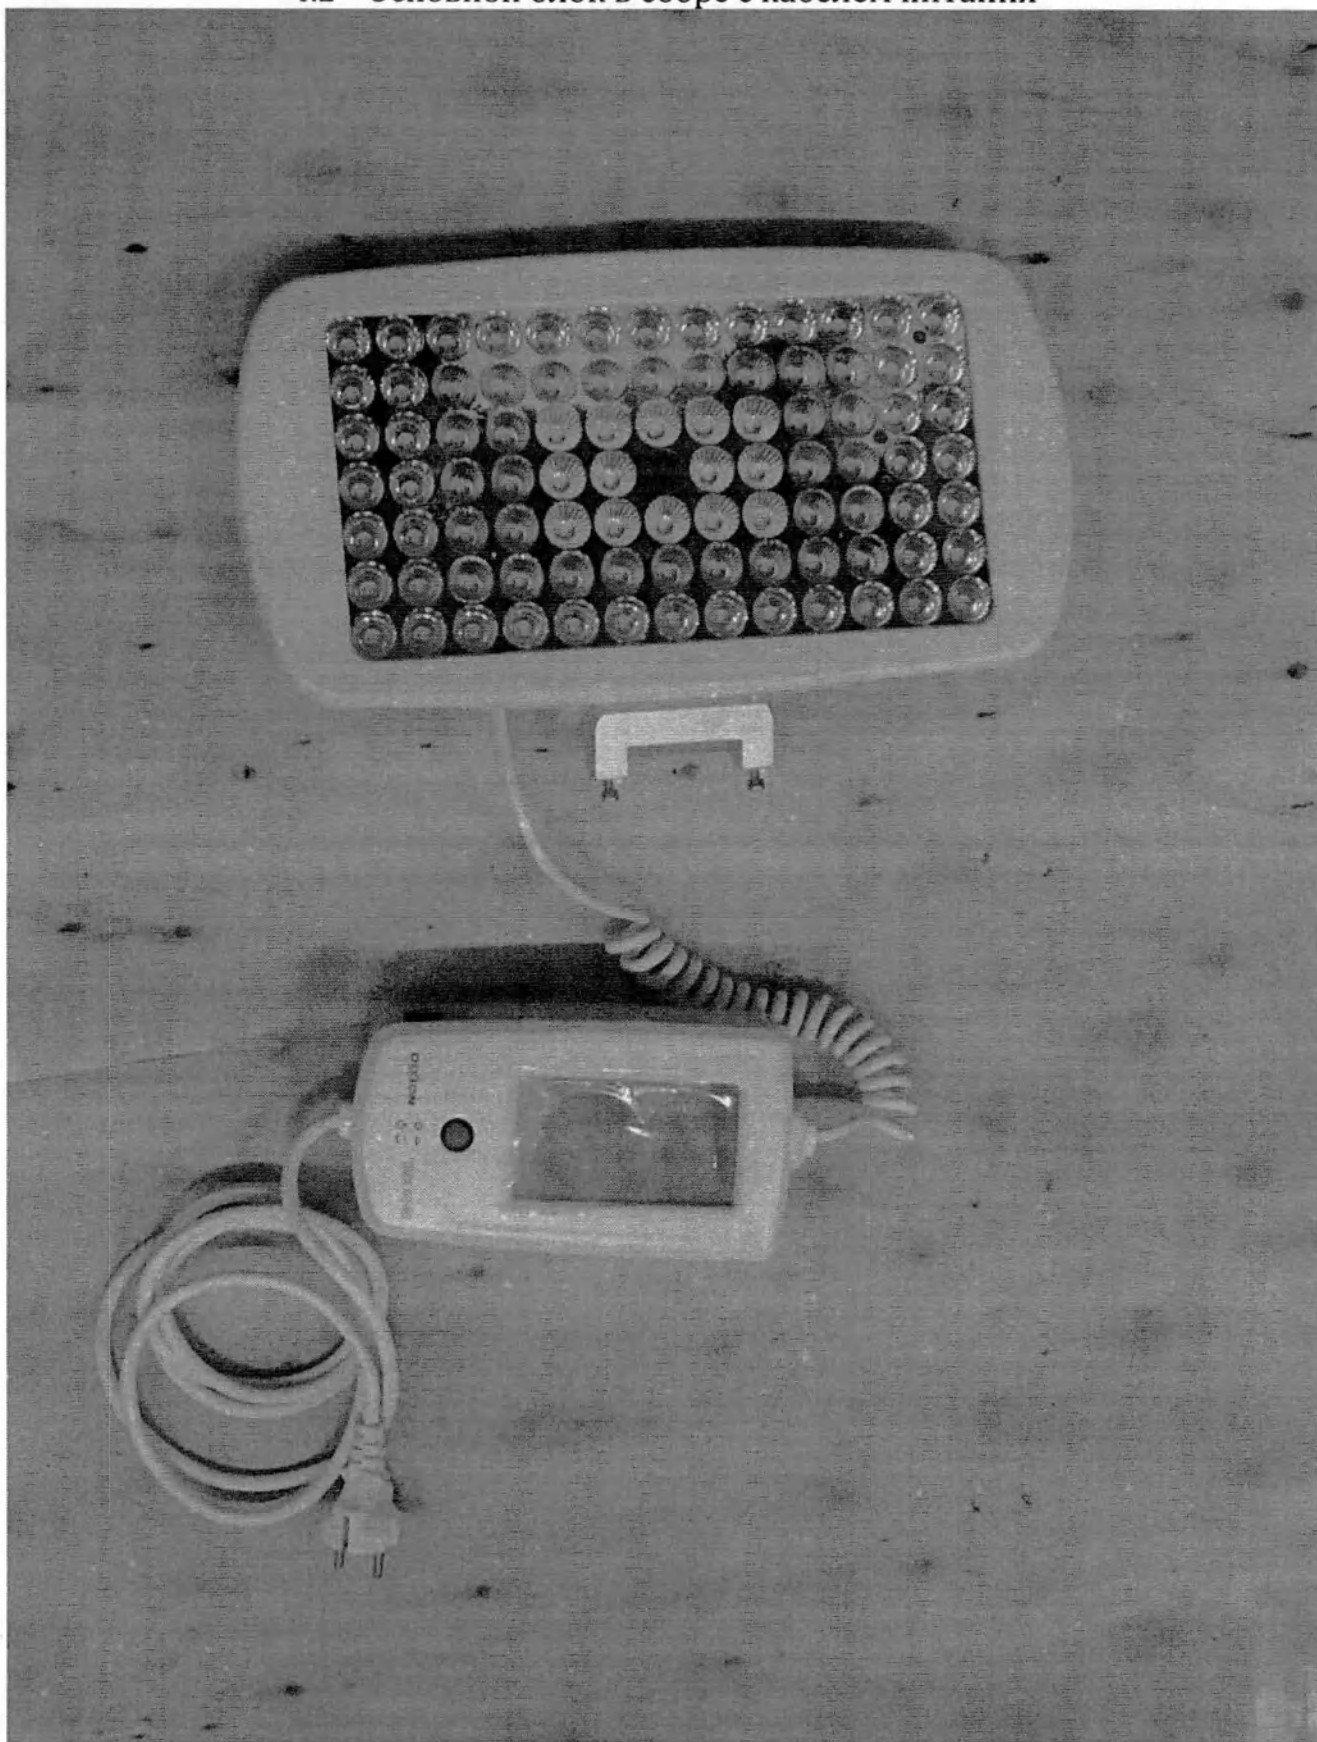


4.3 Основание мобильное

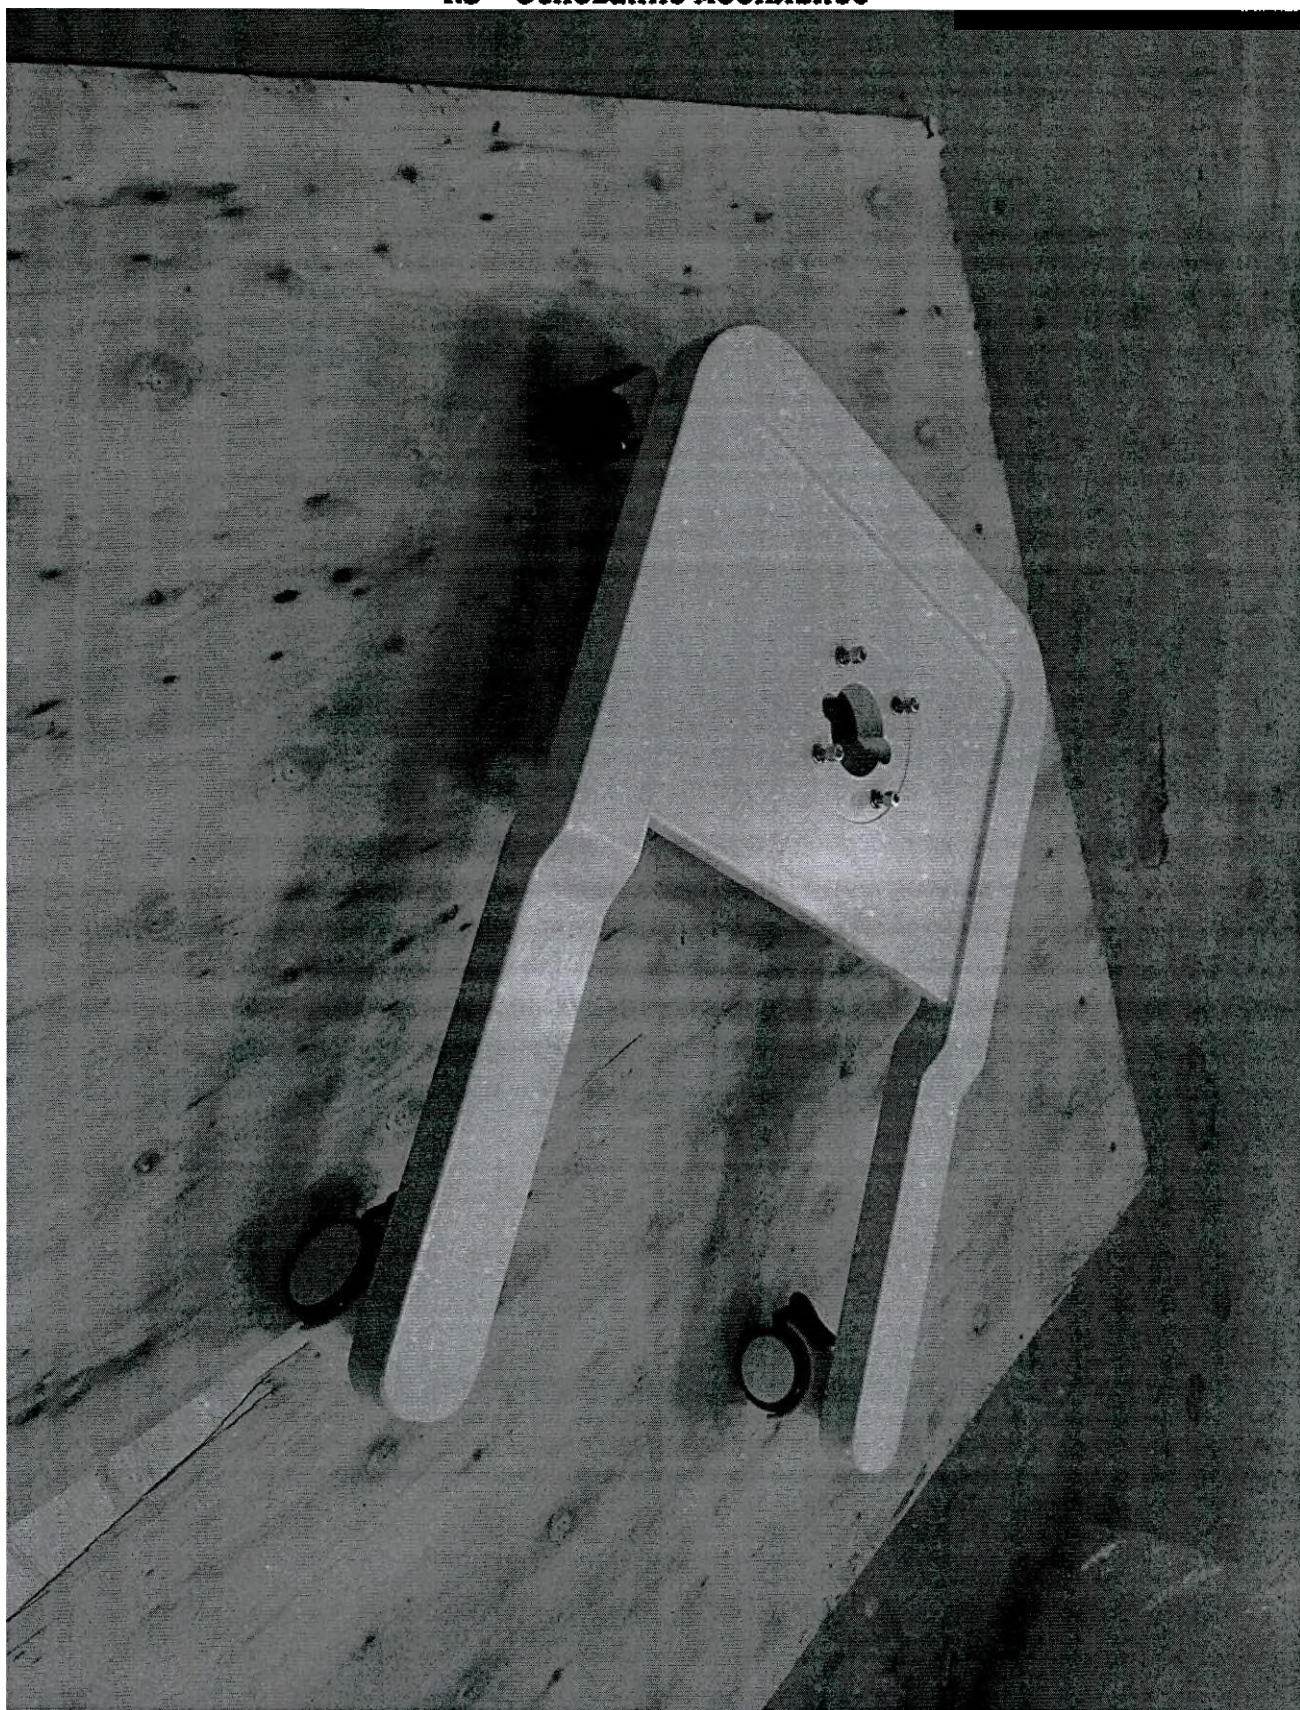


4.4 Стойка с регулировкой высоты

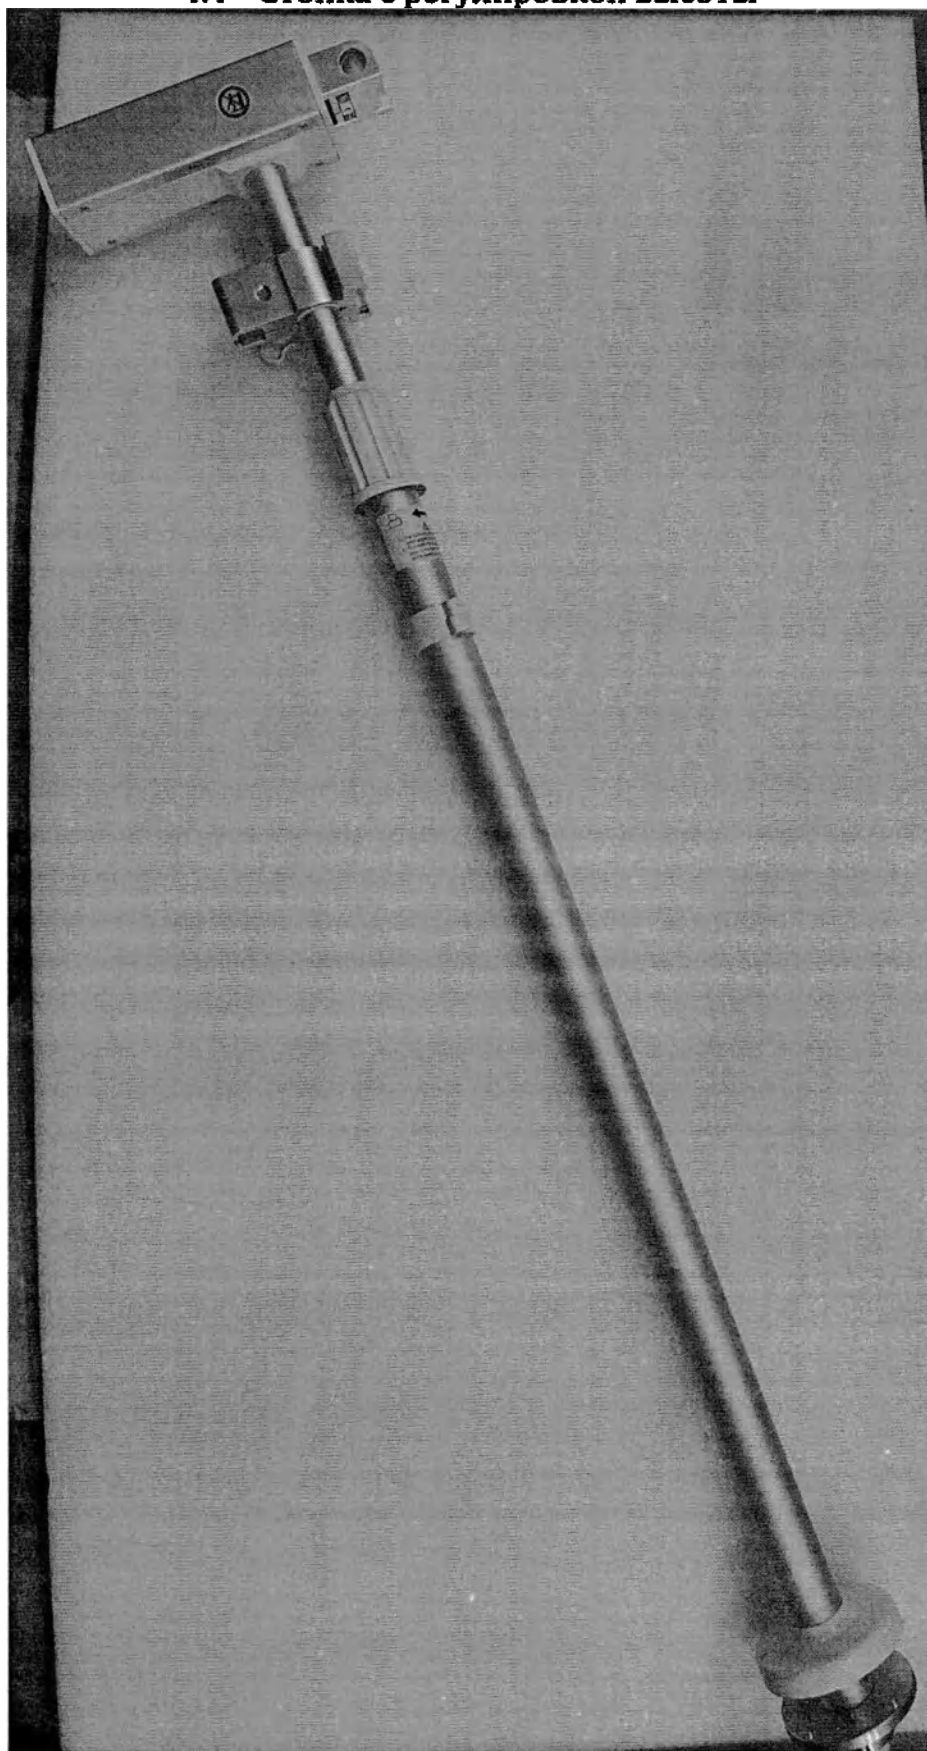

4.5 Предохранитель

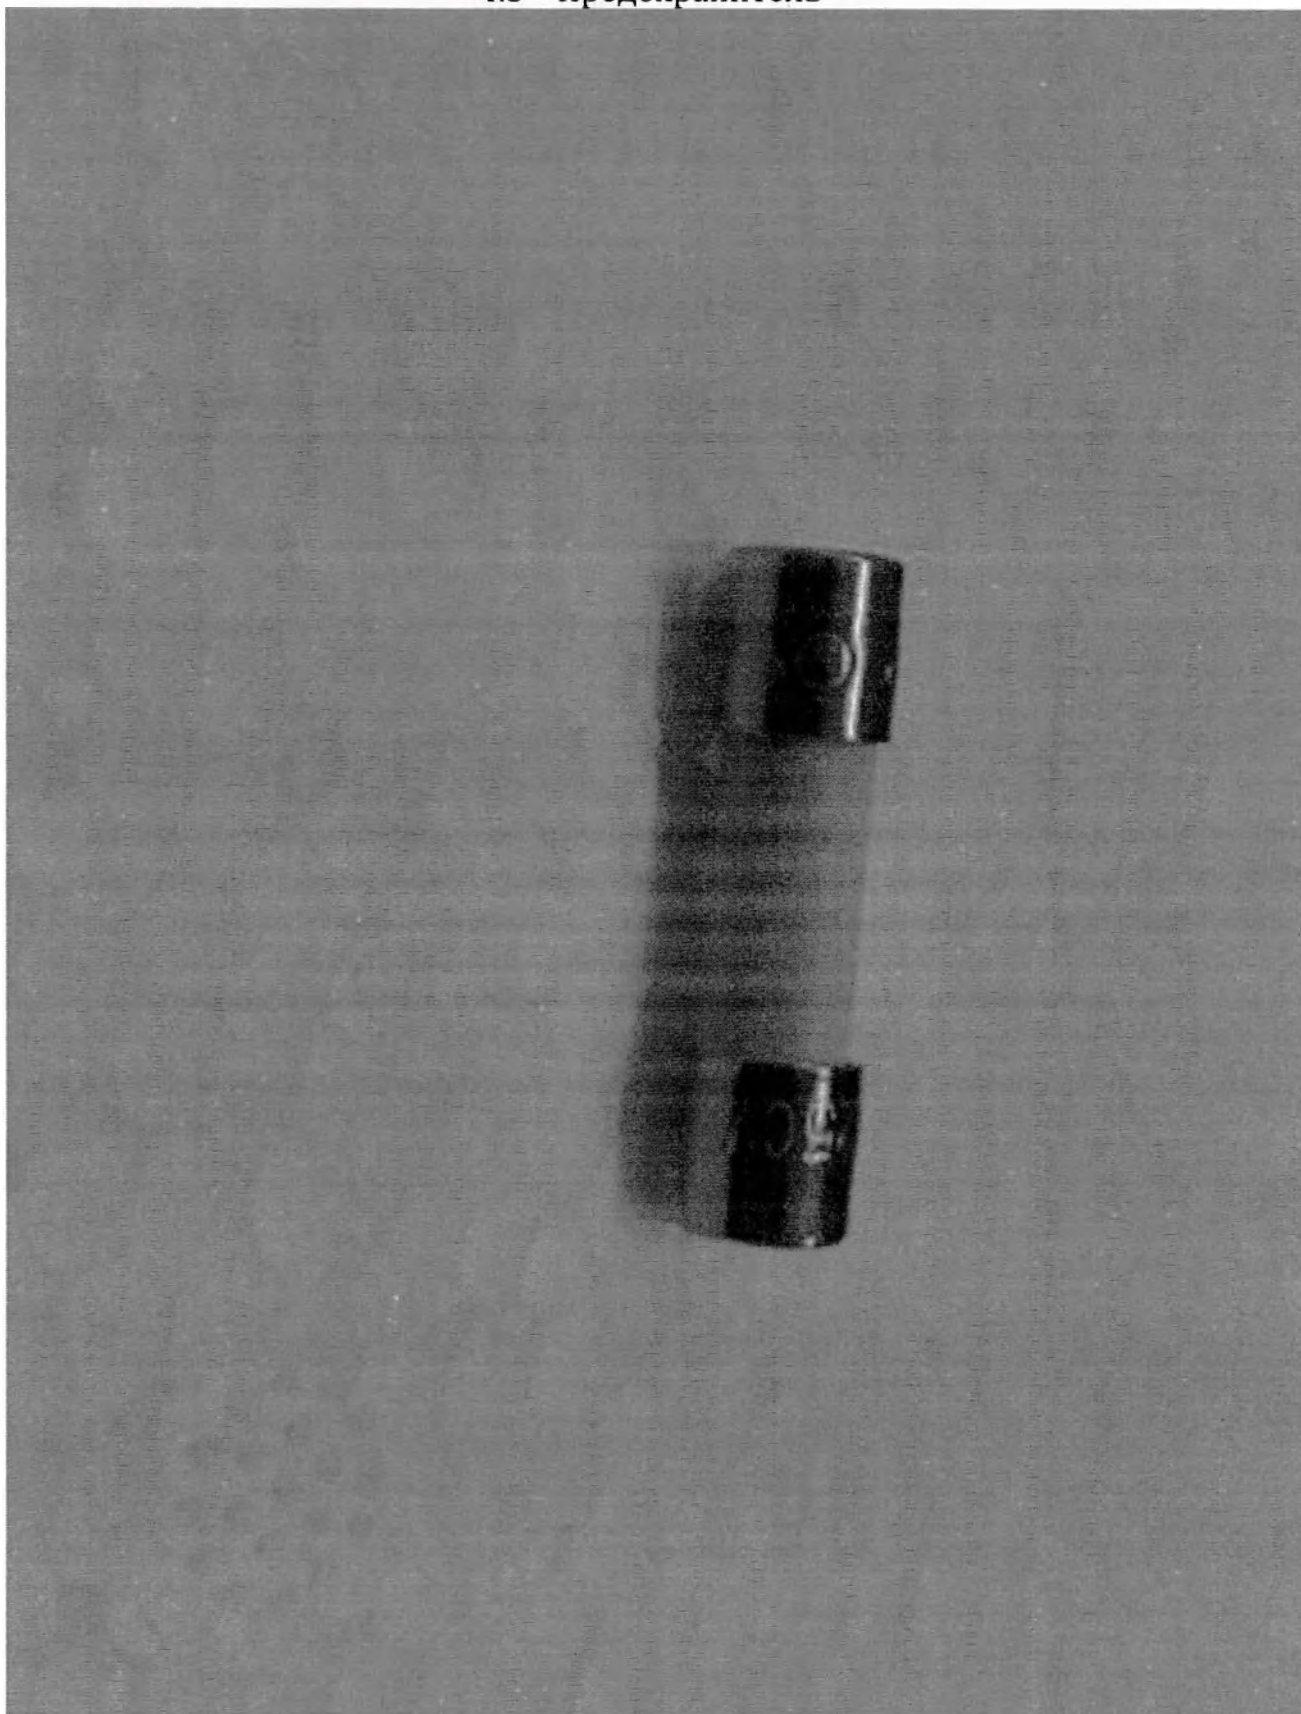

4.6 Пример маркировки аппарата

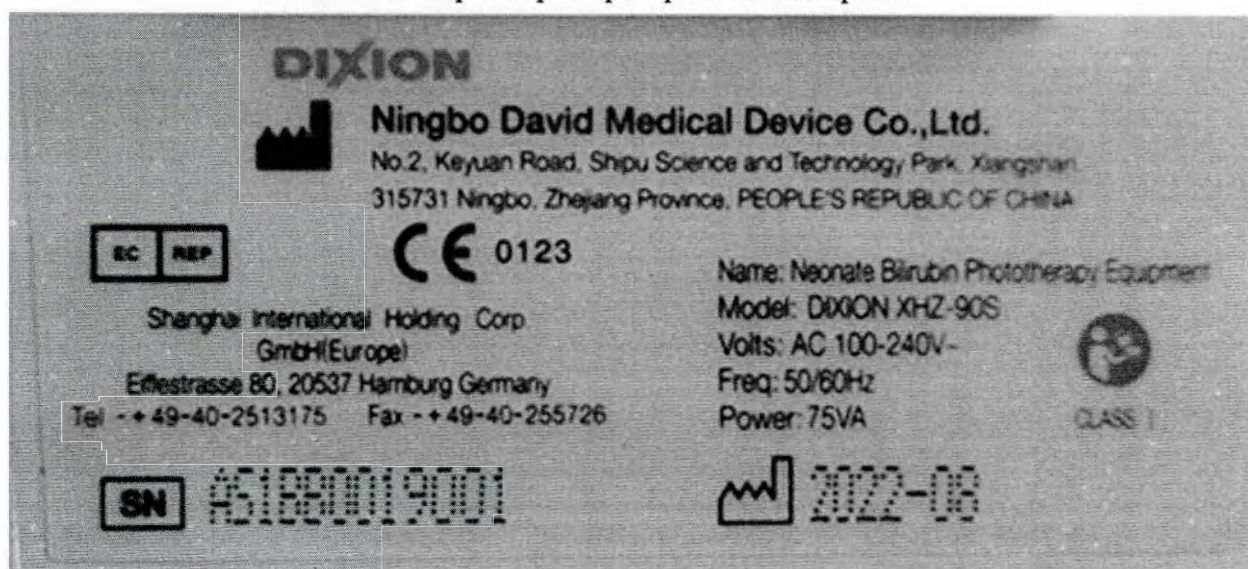


5 Облучатель фототерапевтический неонатальный DIXION XHZ-200


5.1 Общий вид




5.2 Основной блок

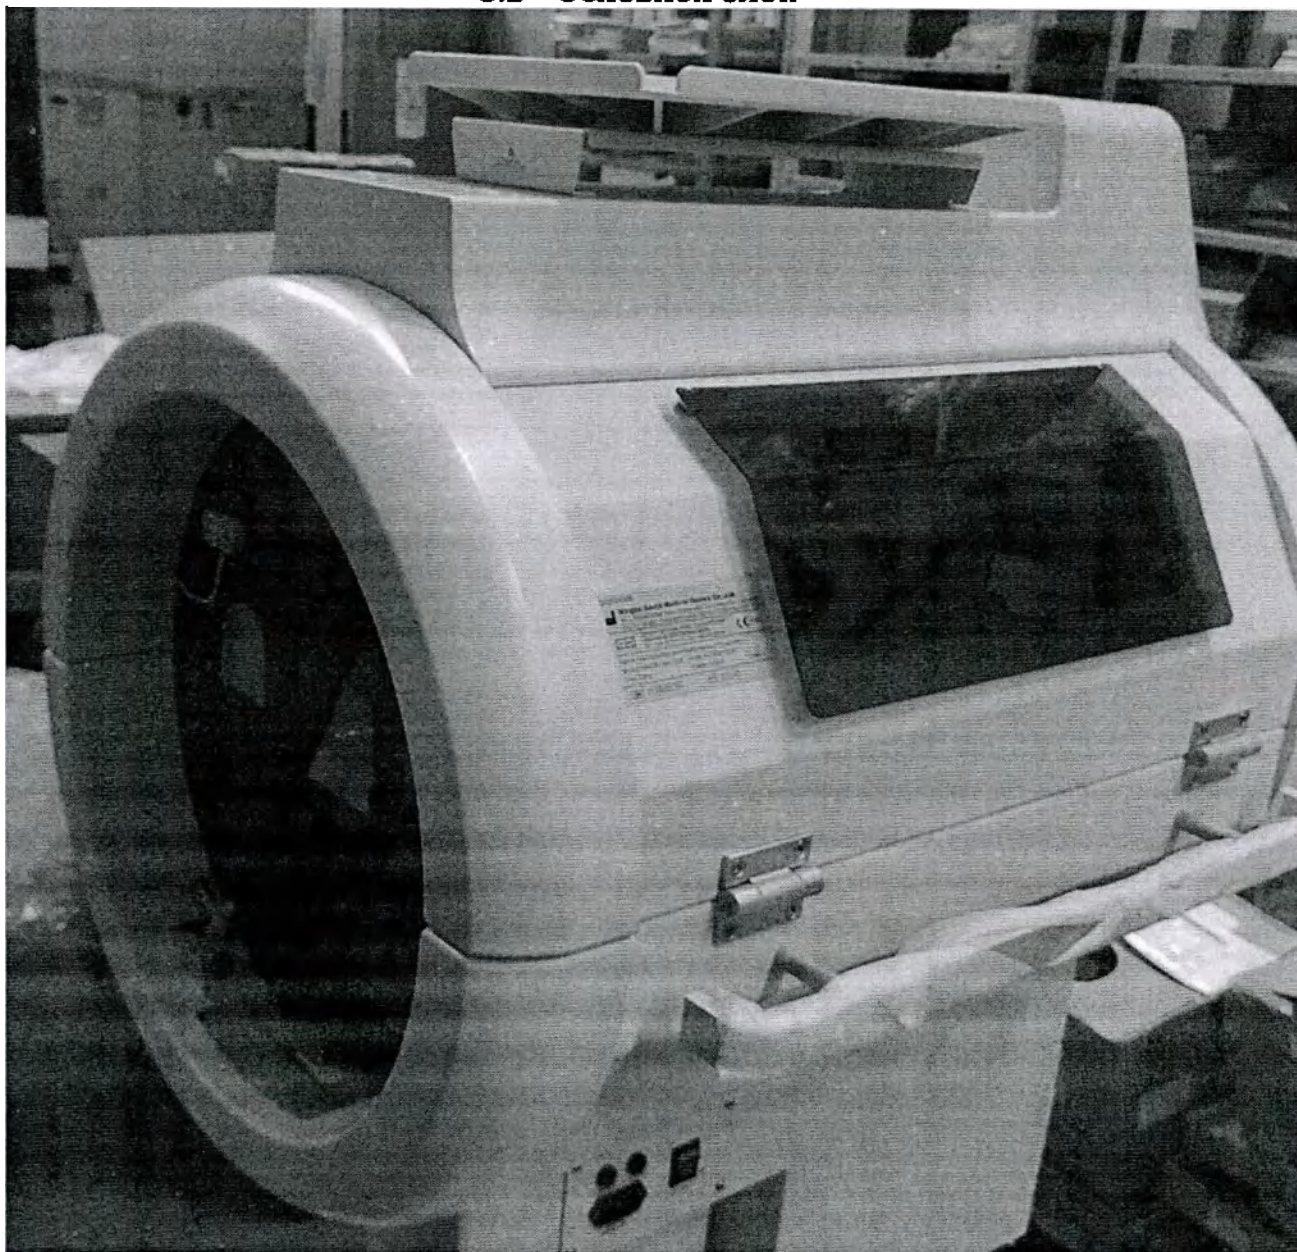


5.3 Мобильный стенд, вариант исполнения: нерегулируемый

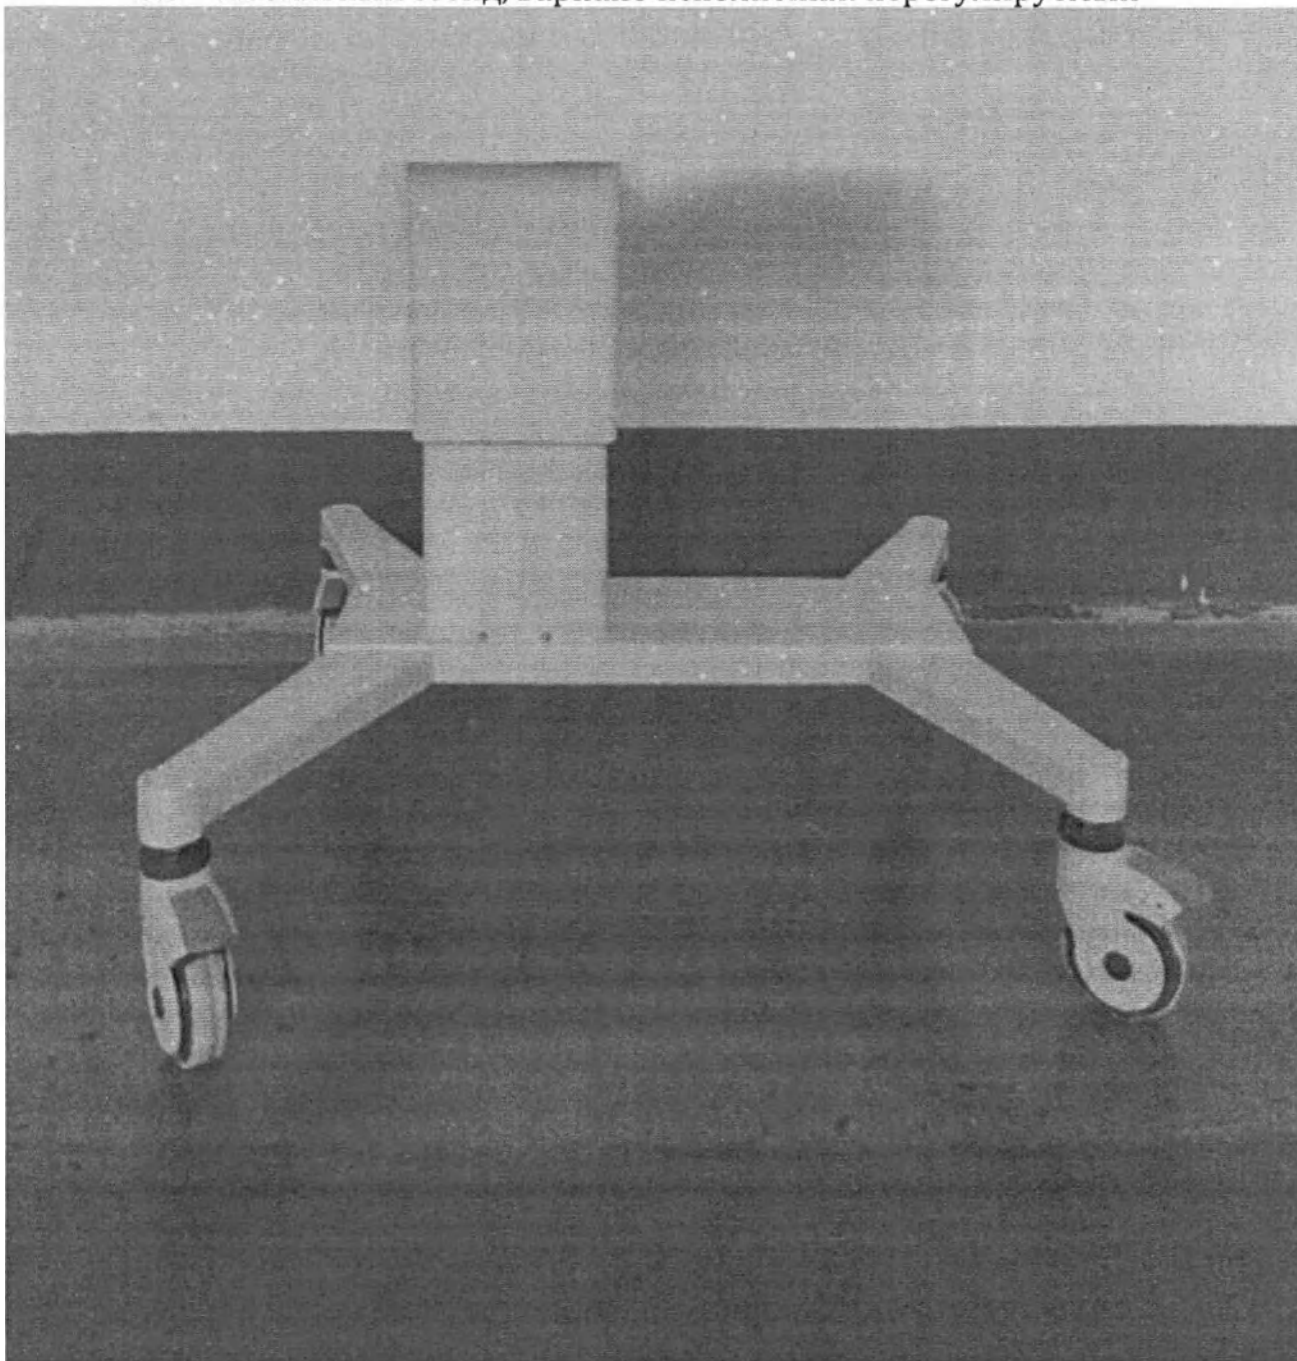


5.4 Мобильный стенд, вариант исполнения: с регулировкой высоты

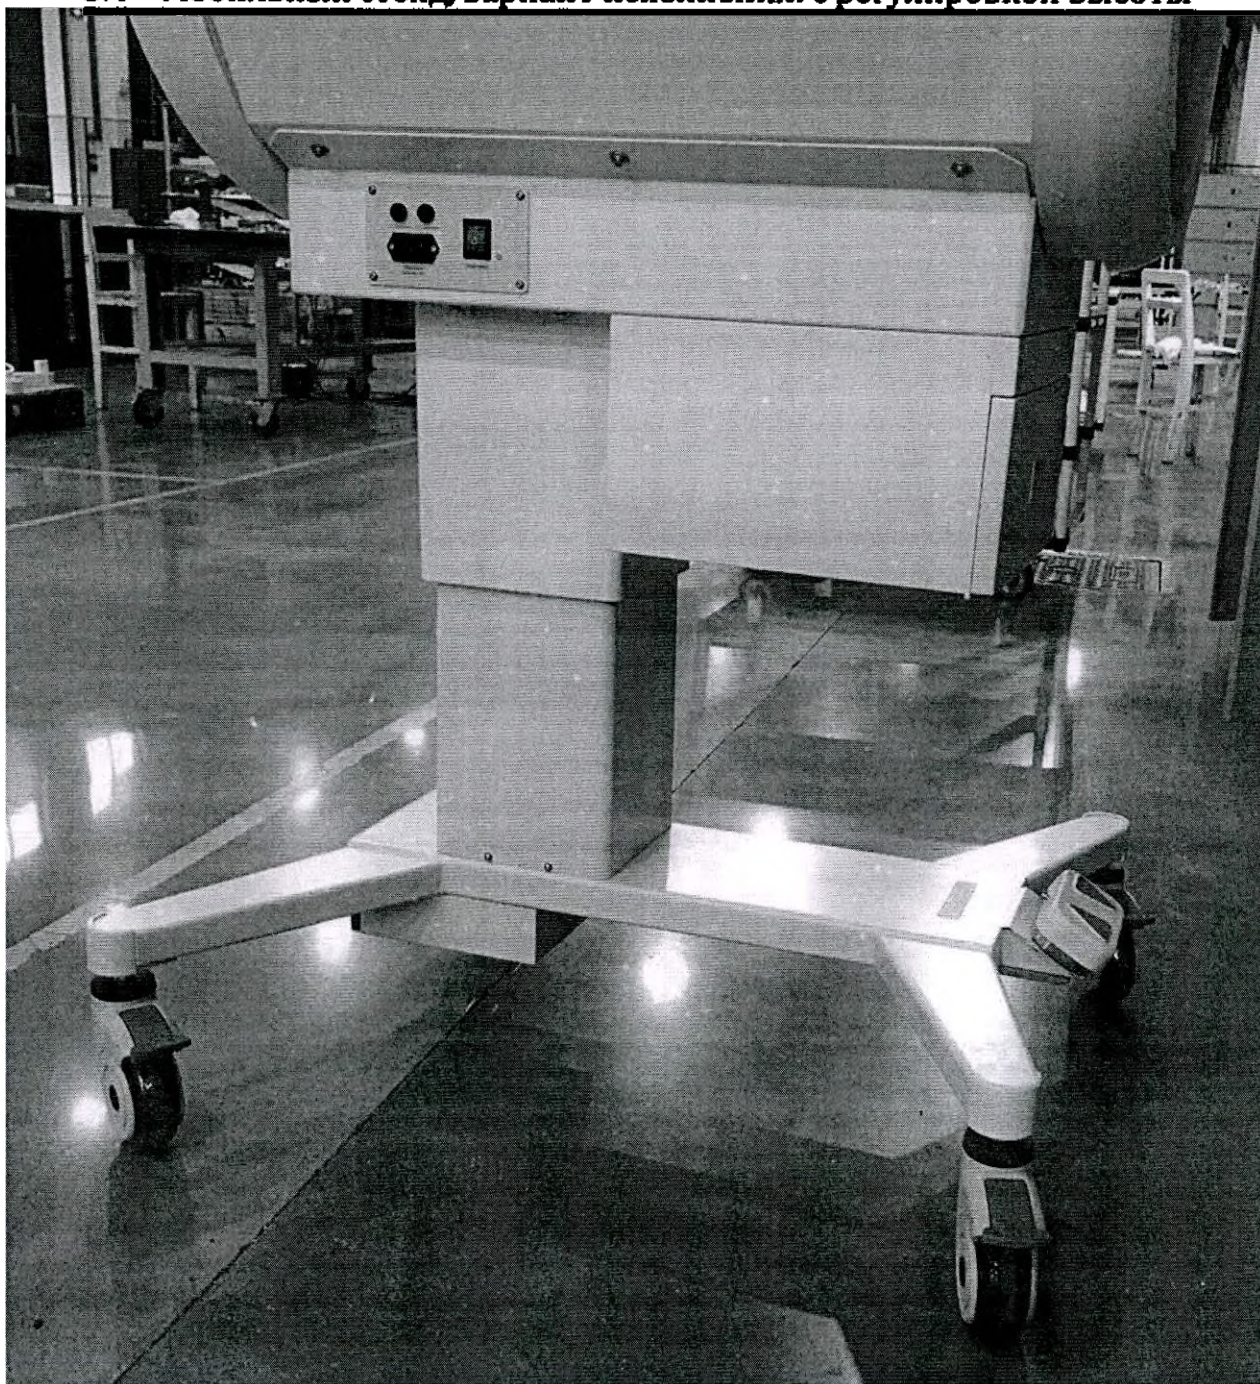

5.5 Кабель питания

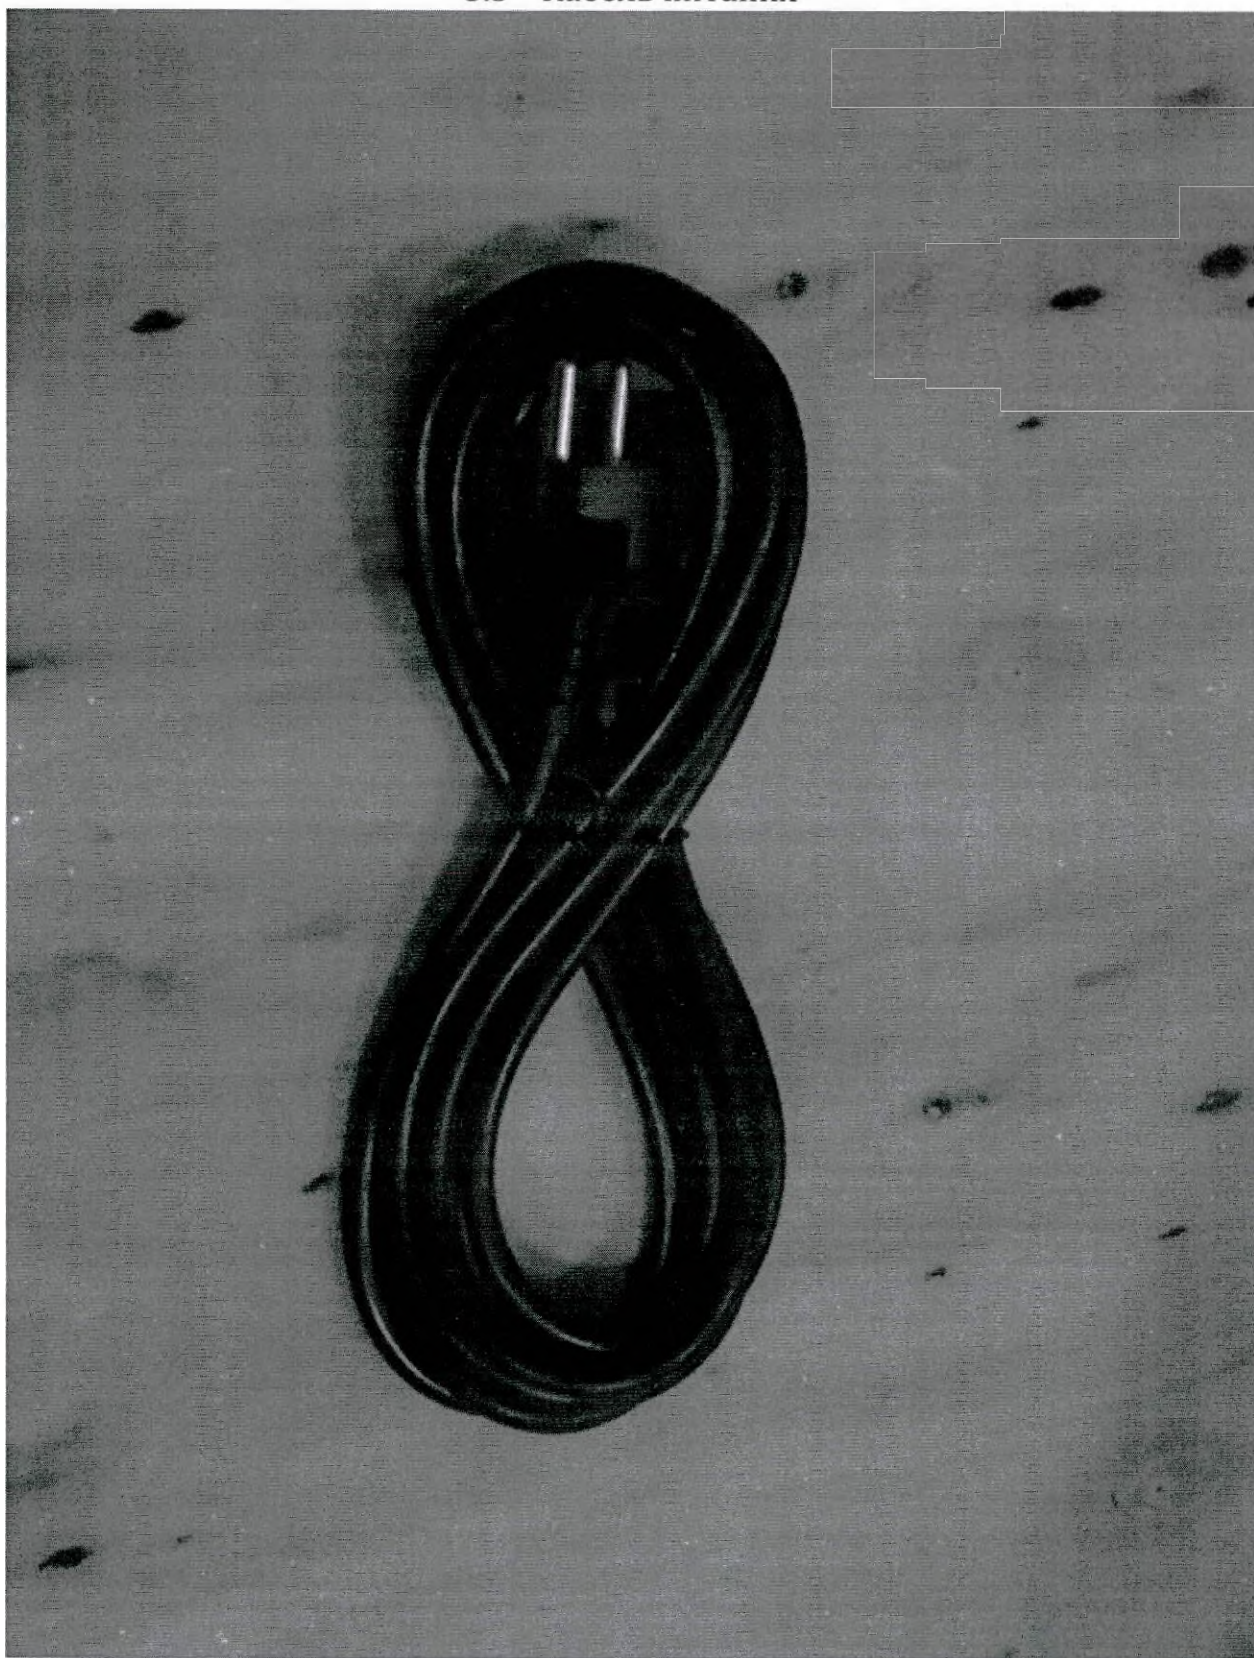


5.6 Кроватка

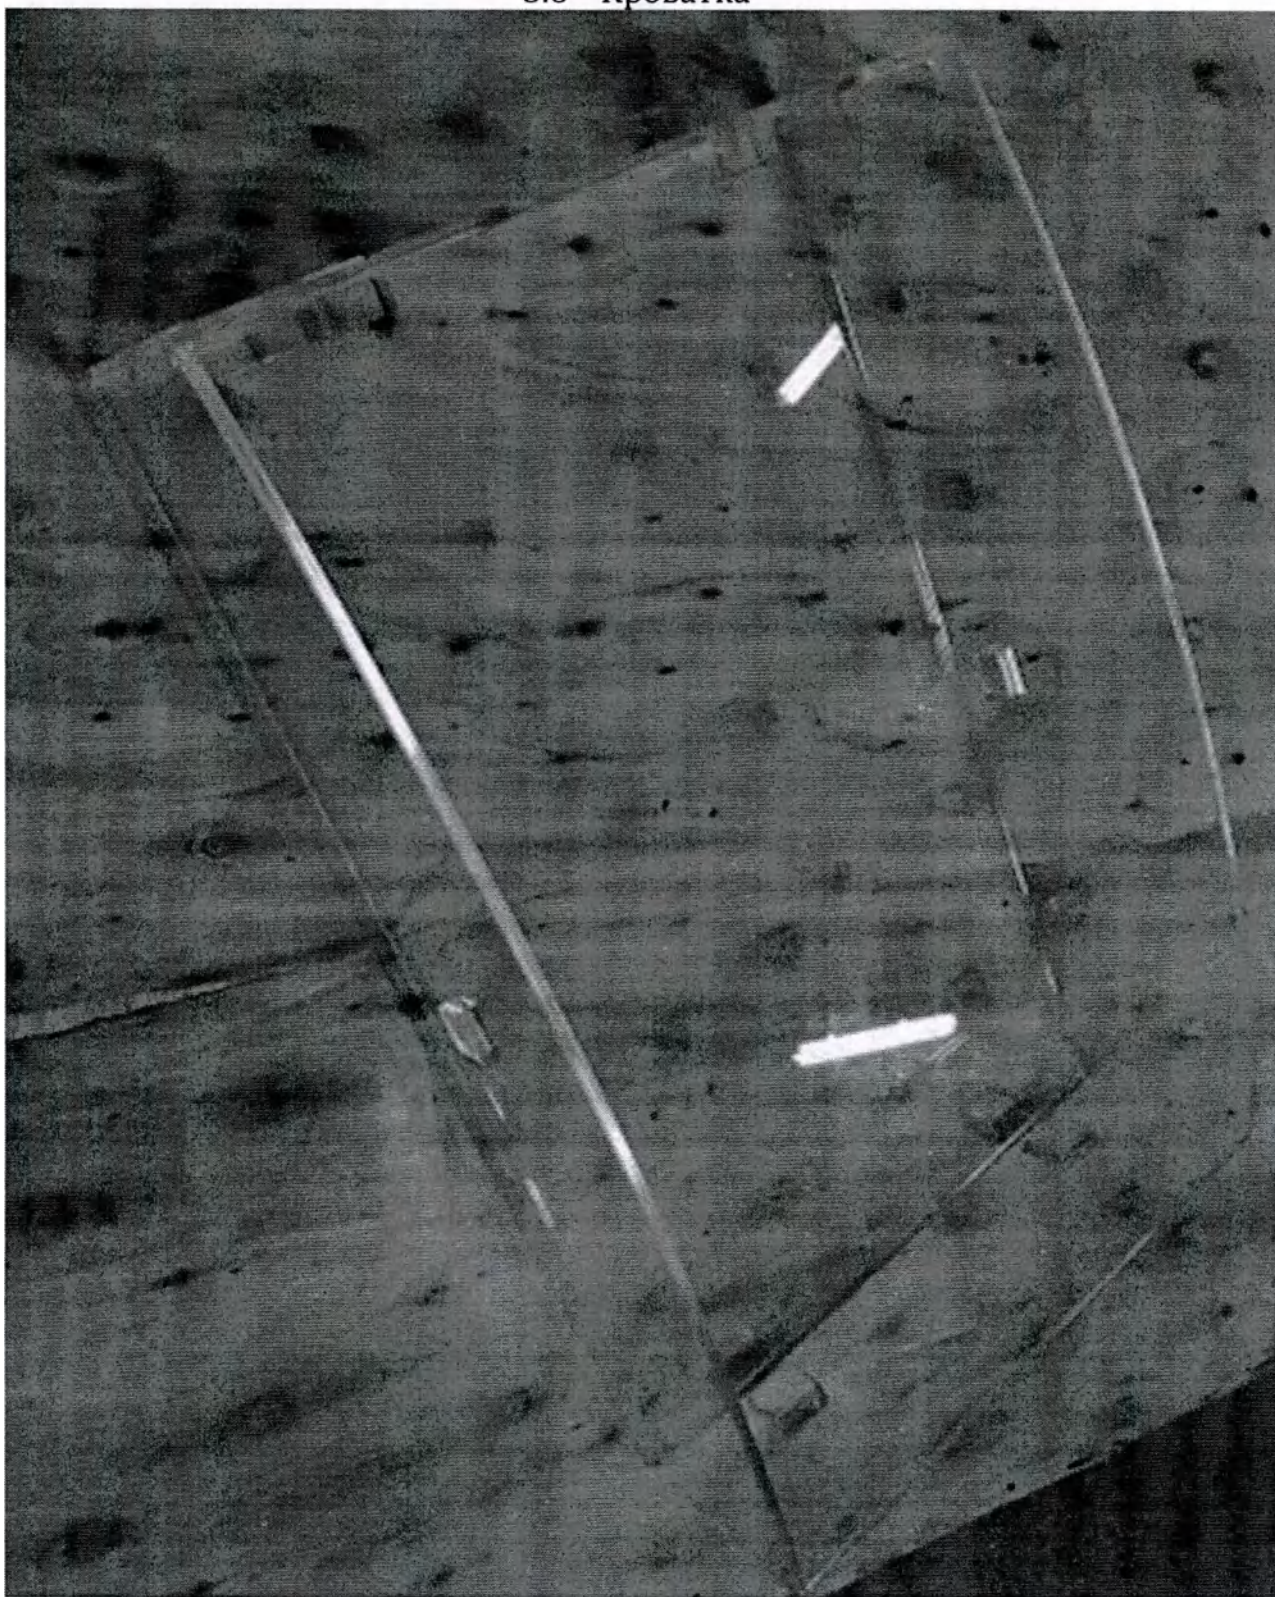

5.7 Матрас сетчатый



5.8 Рамка

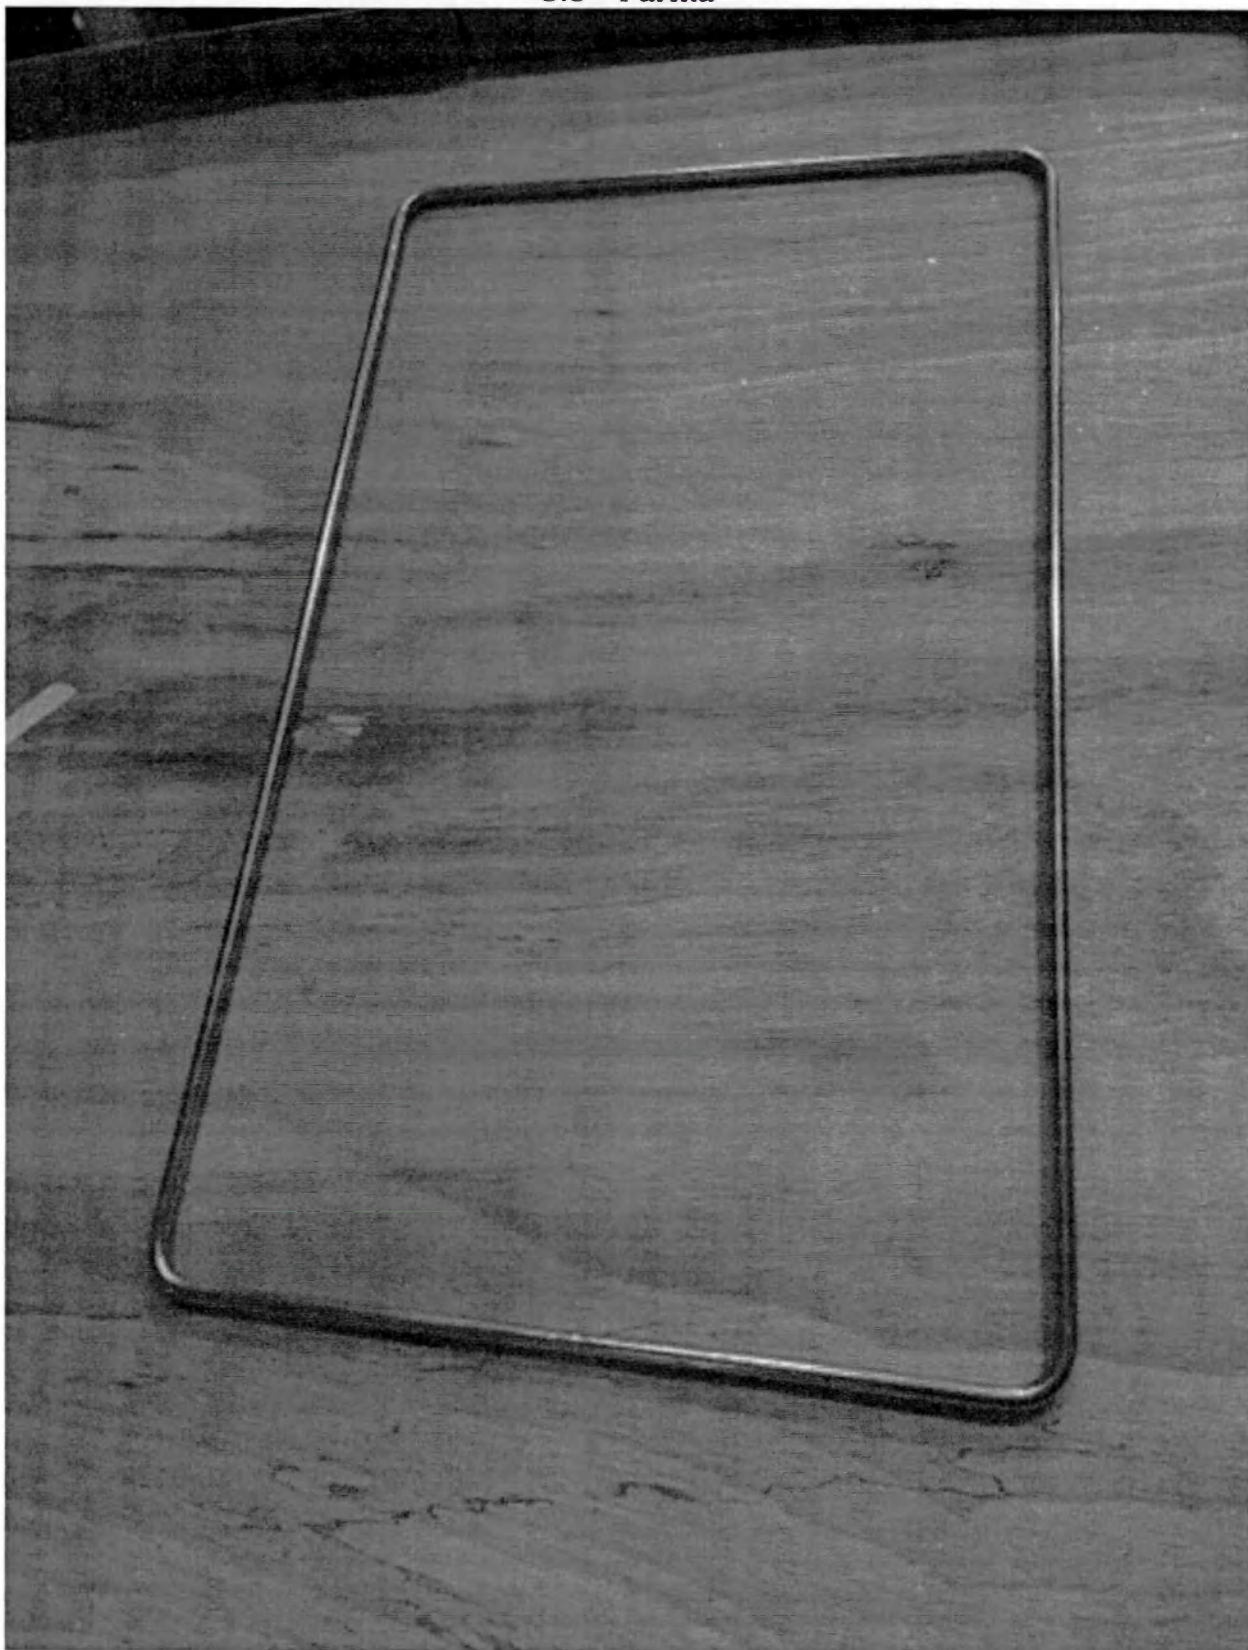


5.9 Матрас гелевый




5.10 Датчик температурный наконечный многоходовый




5.11 Стойка инфузионная

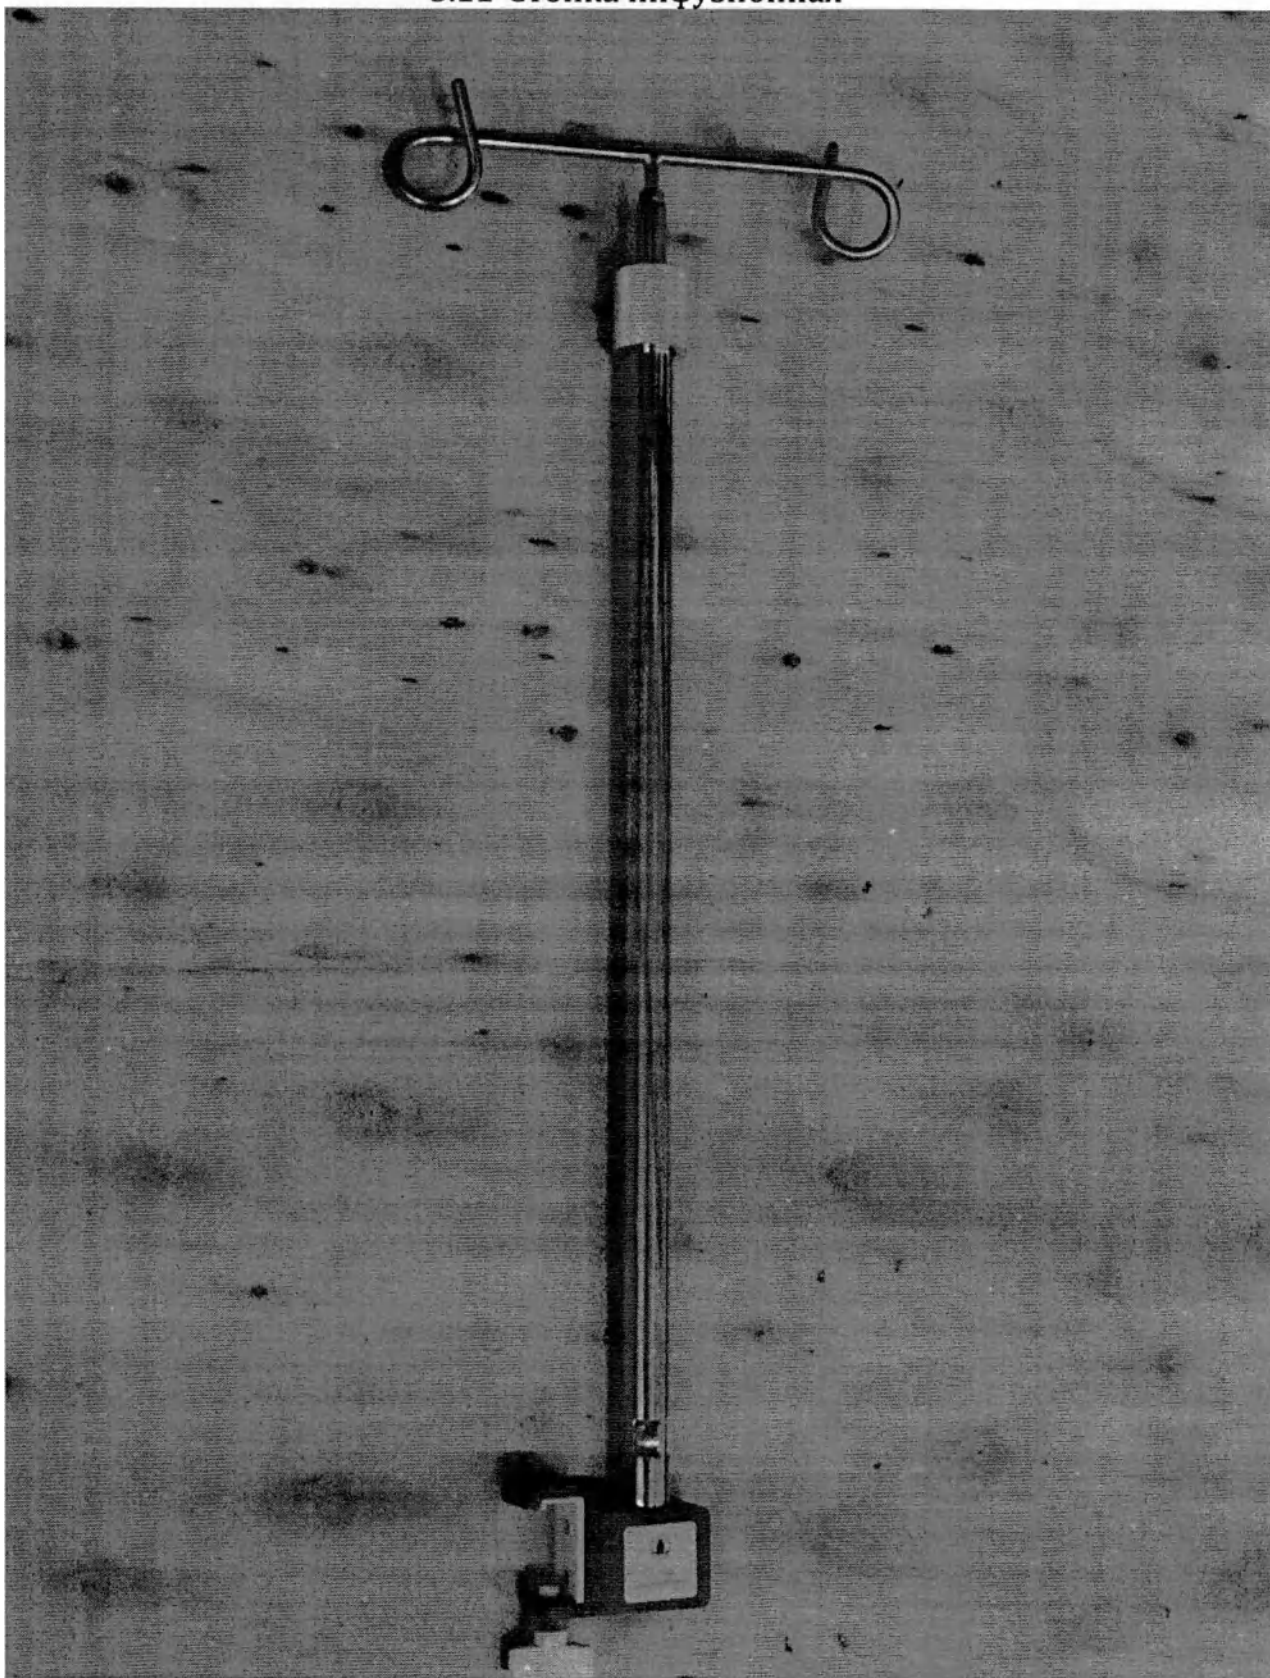


5.12 Предохранитель

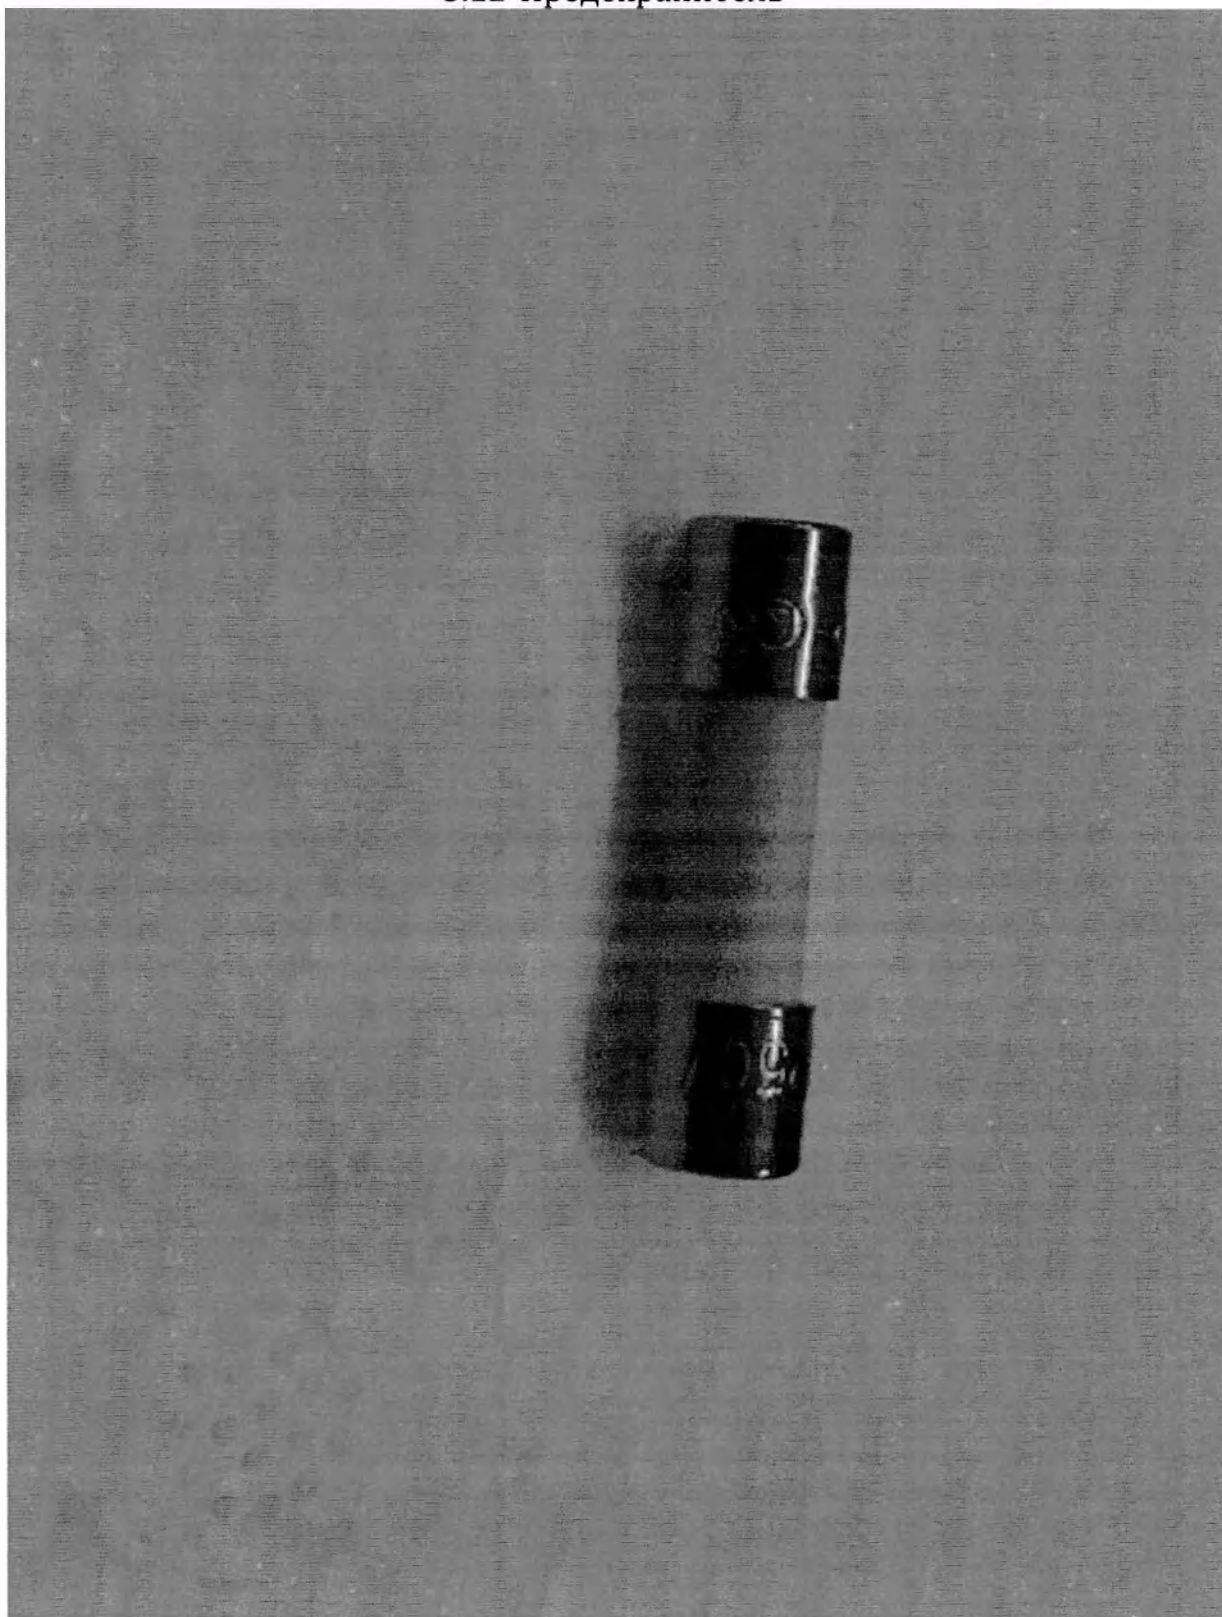

5.13 Лампа светодиодная

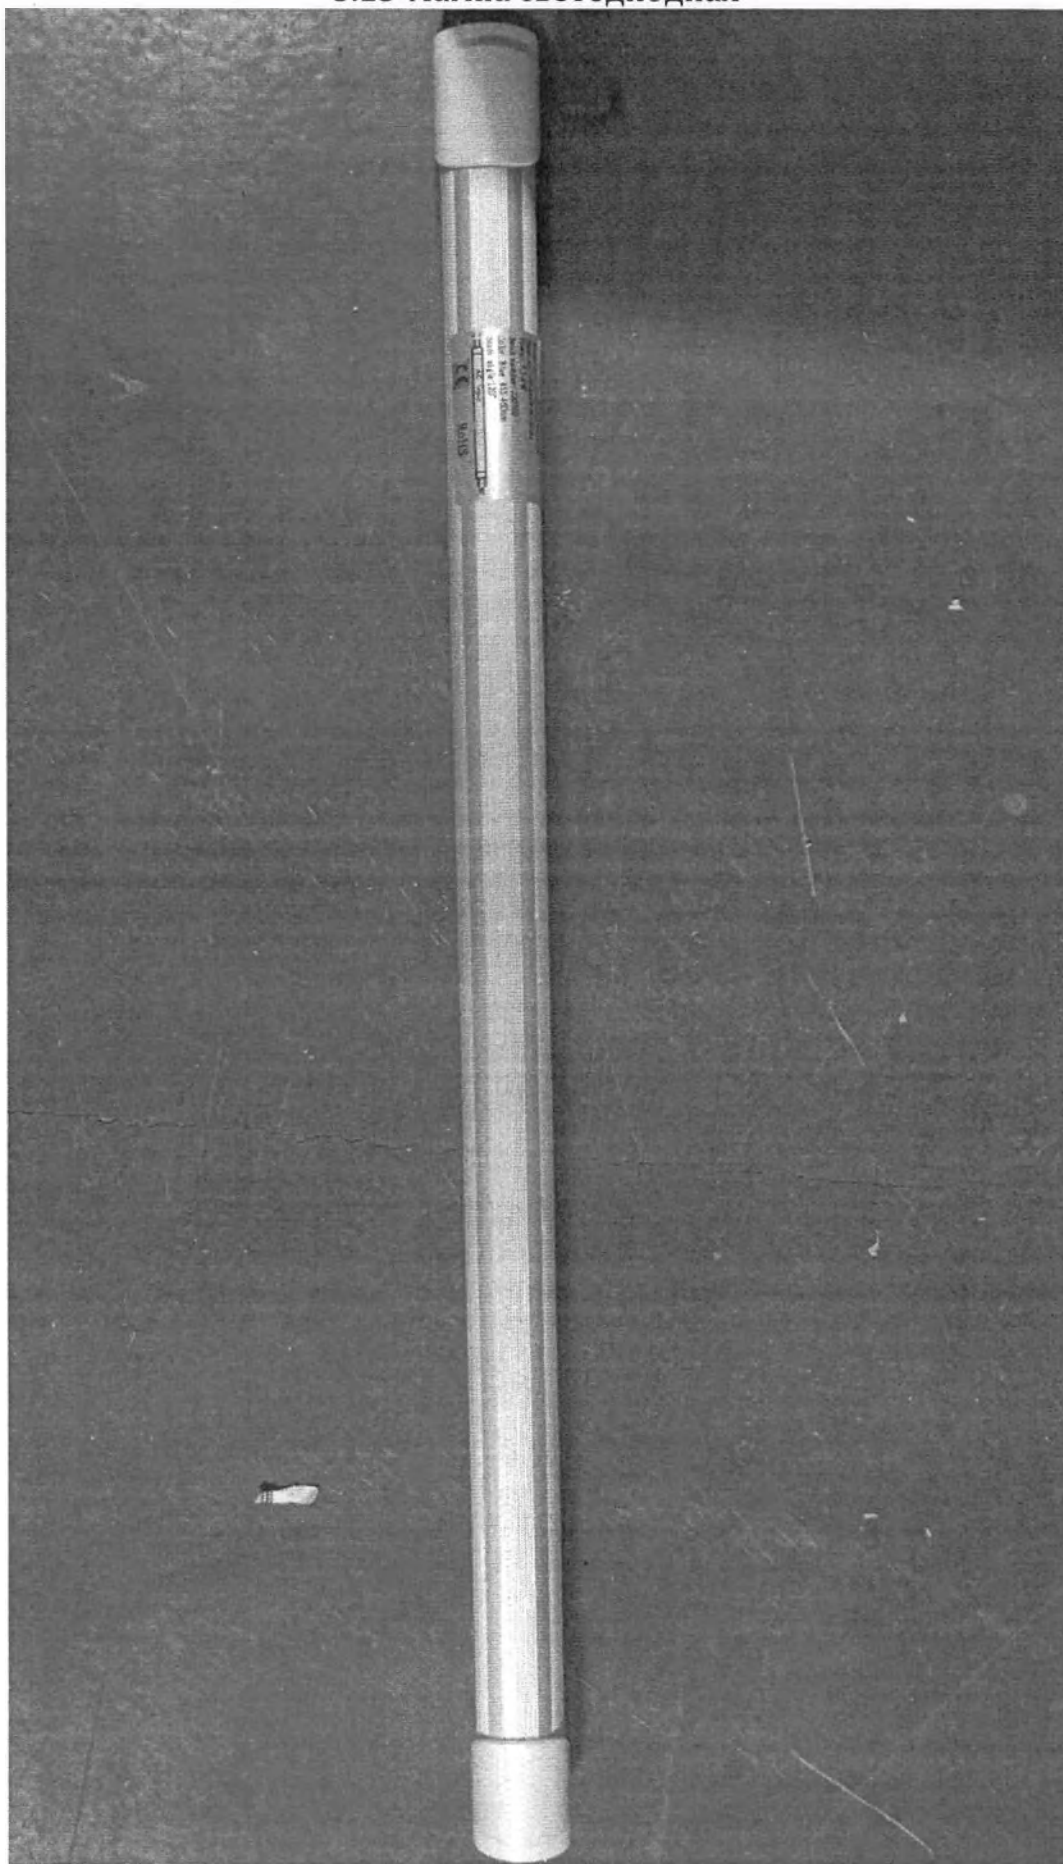

5.14 Пример маркировки аппарата

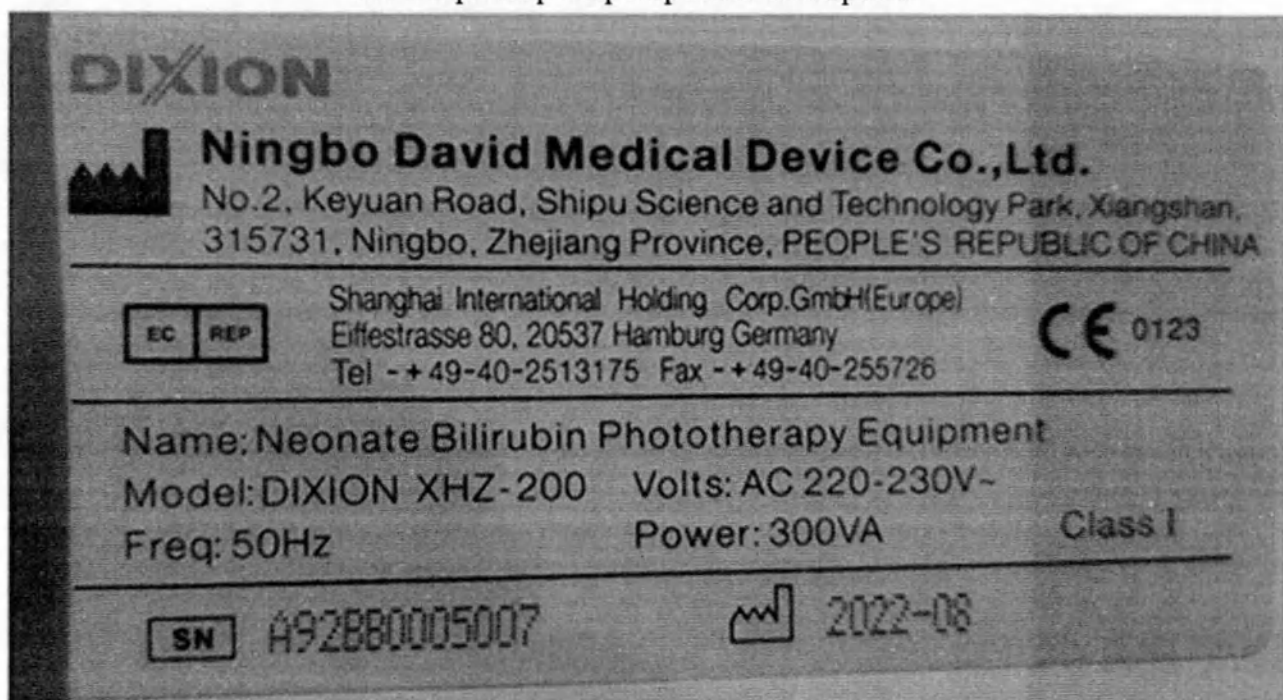

Всего сброшюровано, прошито и
скреплено печатью 48 листов



Генеральный директор ООО «ДИКСИОН»

____ Н.А. Ларина