

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение 192 определений, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ТМБ
СБР
ФСБ-Т(x25)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток
Принадлежности:
Ванночки пластмассовые
Клейкая пленка для планшет

2 шт.
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
2 фл. (по 6,5 мл)
2 фл. (по 13 мл)
1 фл. (2,5 мл)
2 фл. (по 13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (25 мл)

16 шт.

4 шт.
4 шт.

HBsAg, антитела к ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ТУ 9398-037-70423725-2020

РУ №ФСР 2012/13262 от 10.05.2018

Комплект № 1 Каталожный № 01.03.1

Серия 01 Контрольный № 162

Дата изготовления: 2020.03.27

Годен до: 2021.09.27

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 г.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 01 40 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 01 25 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

СБР
с. 01 13 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-1
с. 01 6,5 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-2
с. 01 13 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Иммуносорбент

с. 01
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К+

с. 01 2,0 мл
Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К-

с. 01 2,0 мл
Годен до: 2021.09

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ТМБ
СБР
ФСБ-Т(x25)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток
Принадлежности:
Ванночки пластмассовые
Клейкая пленка для планшет

1 шт.
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (6,5 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (1,25 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (40 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



4 шт.
4 шт.



НВAg, антитела к ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения


ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ТУ 9398-037-70423725-2020

РУ №ФСР 2012/13262 от 10.05.2018

Комплект № 2 Каталогный № 01.03.2
Серия 02 Контрольный № 163



Дата изготовления: 2020.03.27
Годен до: 2021.09.27



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат
Иммуносорбент

с. 02
Годен до: 2021.09




УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"


В.Ю. Борисов

20.10.20




ФСБ-Т(x25)

с. 02 40 мл
Годен до: 2021.09




Стоп-реагент

с. 02 12,5 мл
Годен до: 2021.09




ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

СБР
с. 02 13 мл
Годен до: 2021.09



ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-1
с. 02 6,5 мл
Годен до: 2021.09

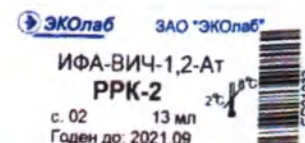

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-2
с. 02 13 мл
Годен до: 2021.09

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



для учреждений здравоохранения

для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Комплект №2а

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат-1

Конъюгат-2

РРК-1

РРК-2

ТМБ

СБР

ФСБ-Т(x25)

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для автоматических пипеток

Принадлежности:

Ванночки пластмассовые

Клейкая пленка для планшет

1 шт.

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (1,0 мл)

1 фл. (1,0 мл)

2 фл. (по 6,5 мл)

2 фл. (по 13 мл)

1 фл. (2,5 мл)

2 фл. (по 13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (25 мл)

16 шт.

4 шт.

4 шт.

НВсAg, антитела к ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ТУ 9398-037-70423725-2020

РУ №ФСР 2012/13262 от 10.05.2018

Комплект № 2а Каталогный № 01.03.2а

Серия 04 Контрольный № 165

Дата изготовления: 2020.03.27

Годен до: 2021.09.27

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20.04.21

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 04 40 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 04 25 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

СБР

с. 04 13 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-1

с. 04 6,5 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-2

с. 04 13 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Иммуносорбент

с. 04

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К+

с. 04 2,0 мл

Годен до: 2021.09

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К-

с. 04 2,0 мл

Годен до: 2021.09

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.

для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Комплект №1/2 Набор рассчитан на проведение 480 определений, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ТМБ
СБР
ФСБ-Т(х25)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток
Принадлежности:
Ванночки пластмассовые
Клейкая пленка для планшет

5 шт.
3 фл. (по 2,0 мл)
3 фл. (по 2,0 мл)
1 фл. (2,5 мл)
1 фл. (2,5 мл)
5 фл. (по 6,5 мл)
5 фл. (по 13 мл)
1 фл. (6,5 мл)
5 фл. (по 13 мл)
3 фл. (по 100 мл)
3 фл. (по 25 мл)

32 шт.

8 шт.
8 шт.

HBsAg, антитела к ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ТУ 9398-037-70423725-2020

РУ №ФСР 2012/13262 от 10.05.2018

Комплект № 1/2 Каталожный № 01.03.1/2

Серия 03 Контрольный № 164

Дата изготовления: 2020.03.27

Годен до: 2021.09.27

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Иммуносорбент

с. 03

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К+

с. 03

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

К-

с. 03

Годен до: 2021.09

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20 г.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(х25)

с. 03

100 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 03

25 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

СБР

с. 03

13 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-1

с. 03

6,5 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Конъюгат-1

с. 03

2,5 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

Конъюгат-2

с. 03

2,5 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ТМБ

с. 03

6,5 мл

Годен до: 2021.09

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

РРК-2

с. 03

13 мл

Годен до: 2021.09

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а

Зам.Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

09 2021 г.







Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов» «ИФА-ВИЧ-1,2-Ат» с принадлежностями,
необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

Комплект №1 Серия 01 от 03.2020 г.





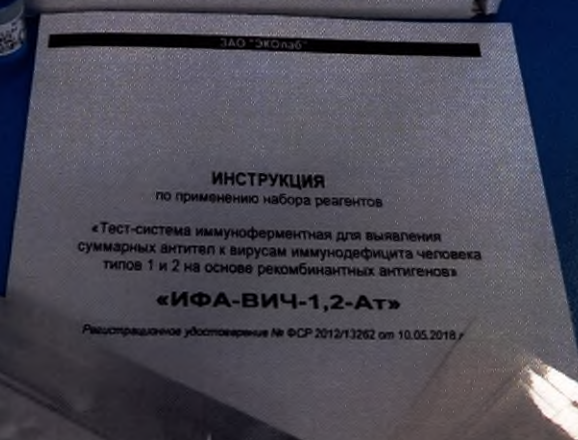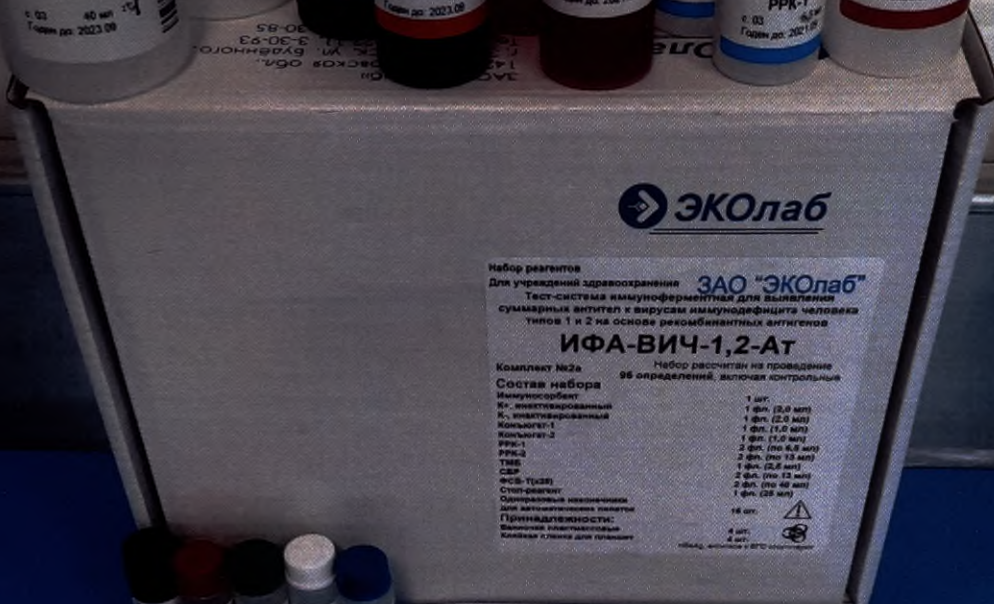

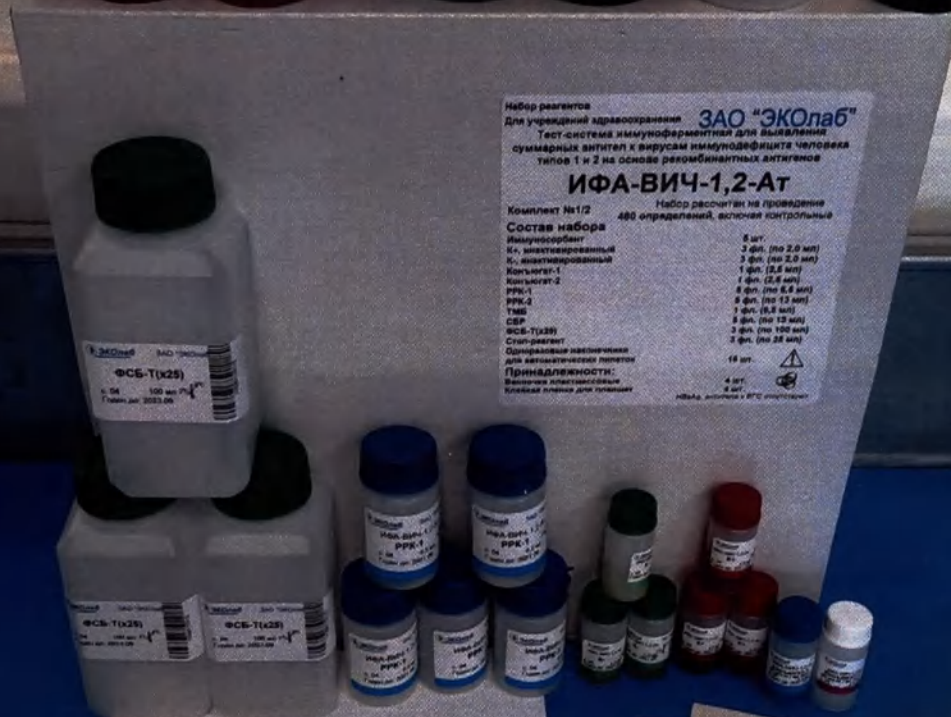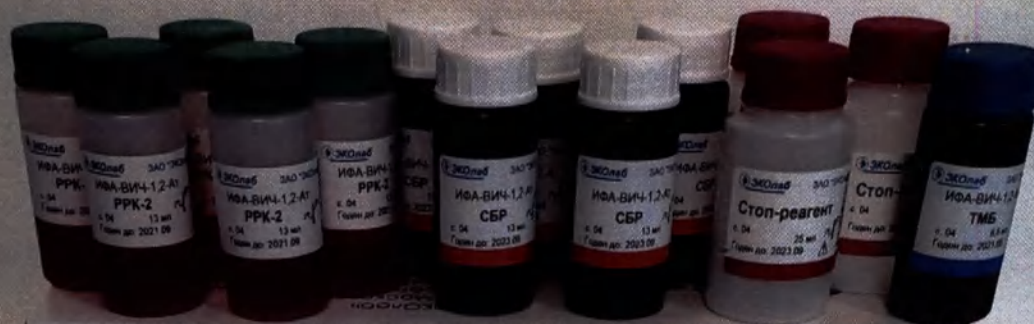

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения ЗАО "ЭКОлаб"
Тест-система иммуноферментная для выявления
суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека
типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов
ИФА-ВИЧ-1,2-Ат
Набор реагентов на проведение
480 определений, включая контрольные

Комплект №1/2


Состав набора

Иммуносорбент	5 шт.
И-материализованный	3 фл. (по 2,0 мл)
И-материализованный	3 фл. (по 2,0 мл)
Конъюгат-1	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат-2	1 фл. (2,5 мл)
РРК-1	8 фл. (по 8,8 мл)
РРК-2	8 фл. (по 11 мл)
ТМБ	1 фл. (8,8 мл)
СБР	8 фл. (по 15 мл)
СБР-Т(х38)	3 фл. (по 100 мл)
Стоп-реагент	3 фл. (по 25 мл)
Смешивающая жидкость для автоматического перемешивания	18 шт.
Применение: для автоматического перемешивания	4 шт.
Применение: для автоматического перемешивания	8 шт.

ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для выявления
суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека
типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов»
«ИФА-ВИЧ-1,2-Ат»
серия № 04 от 03.2020 г.



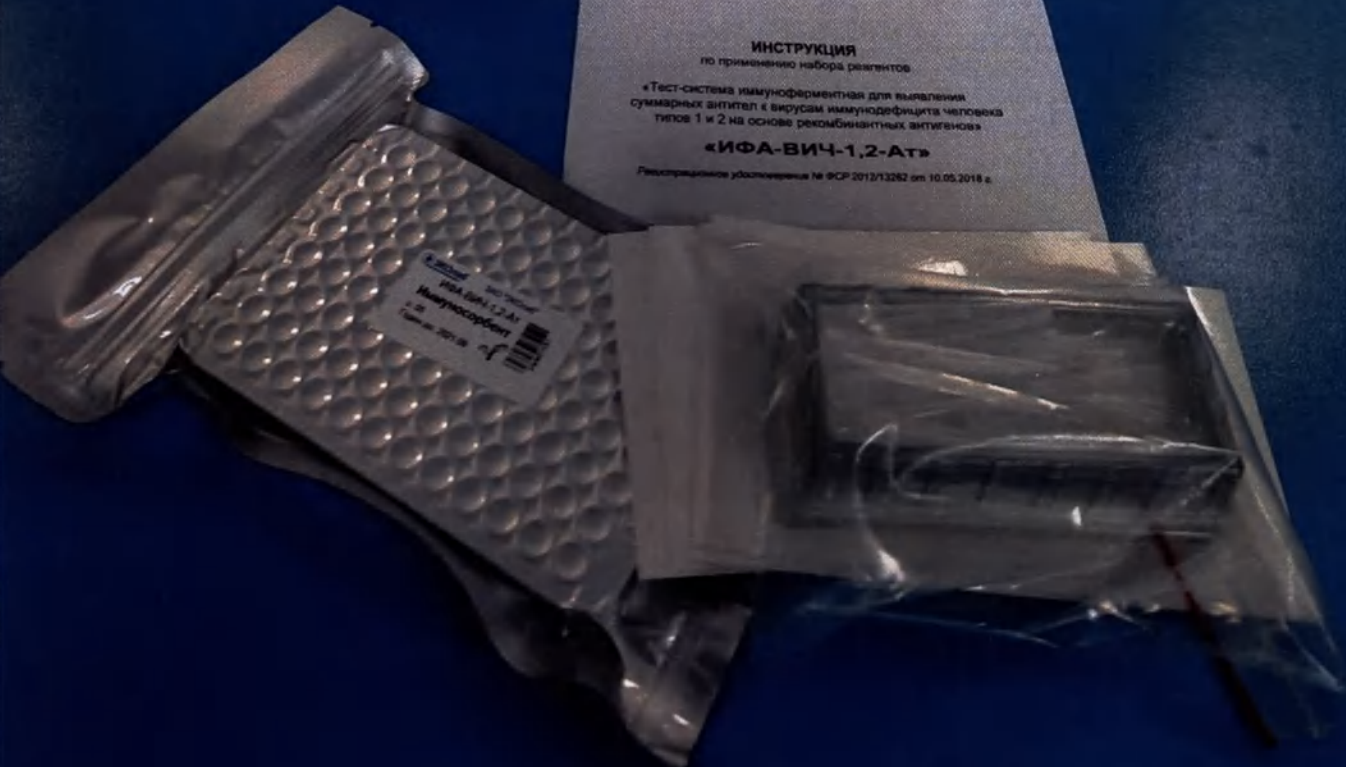






ИФА-ВИЧ-1,2-Ат

10.  10. 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13262 от 10.05.2018 г.



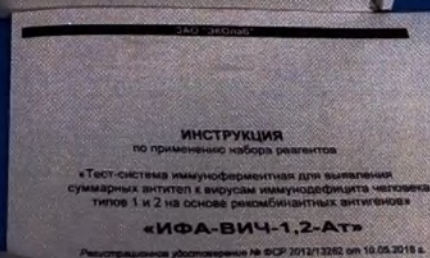

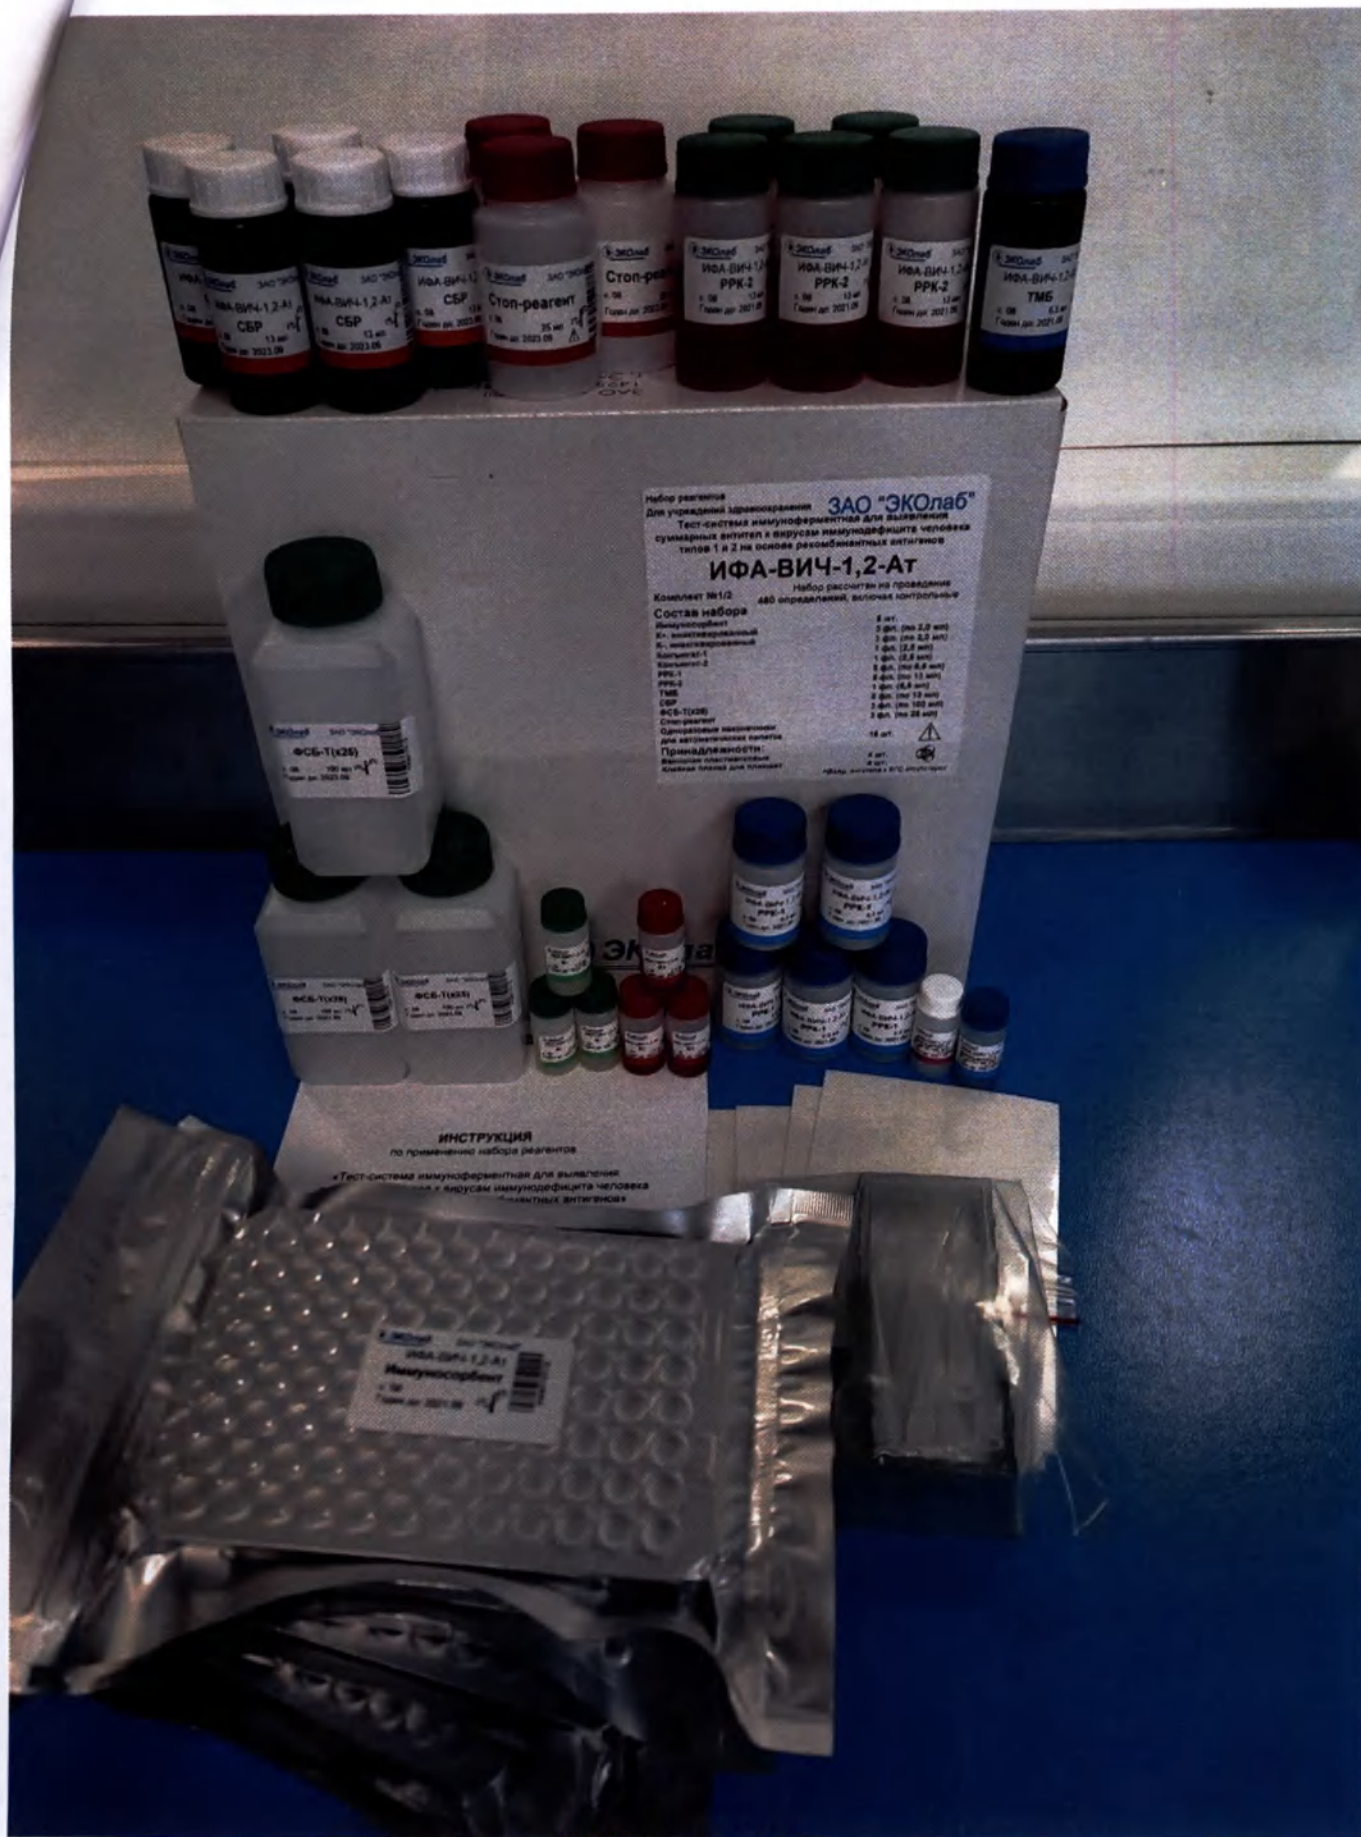

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.

