



Фотографические изображения общего вида
«Набора реагентов для определения антител к комплексу О-антигенов сальмонелл групп А, В, С1, С2, D, Е в реакции пассивной гемагглютинации»
«О-комплекс Сальмонелла РПГА»
 с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

Серия 01 от 2021.02.24

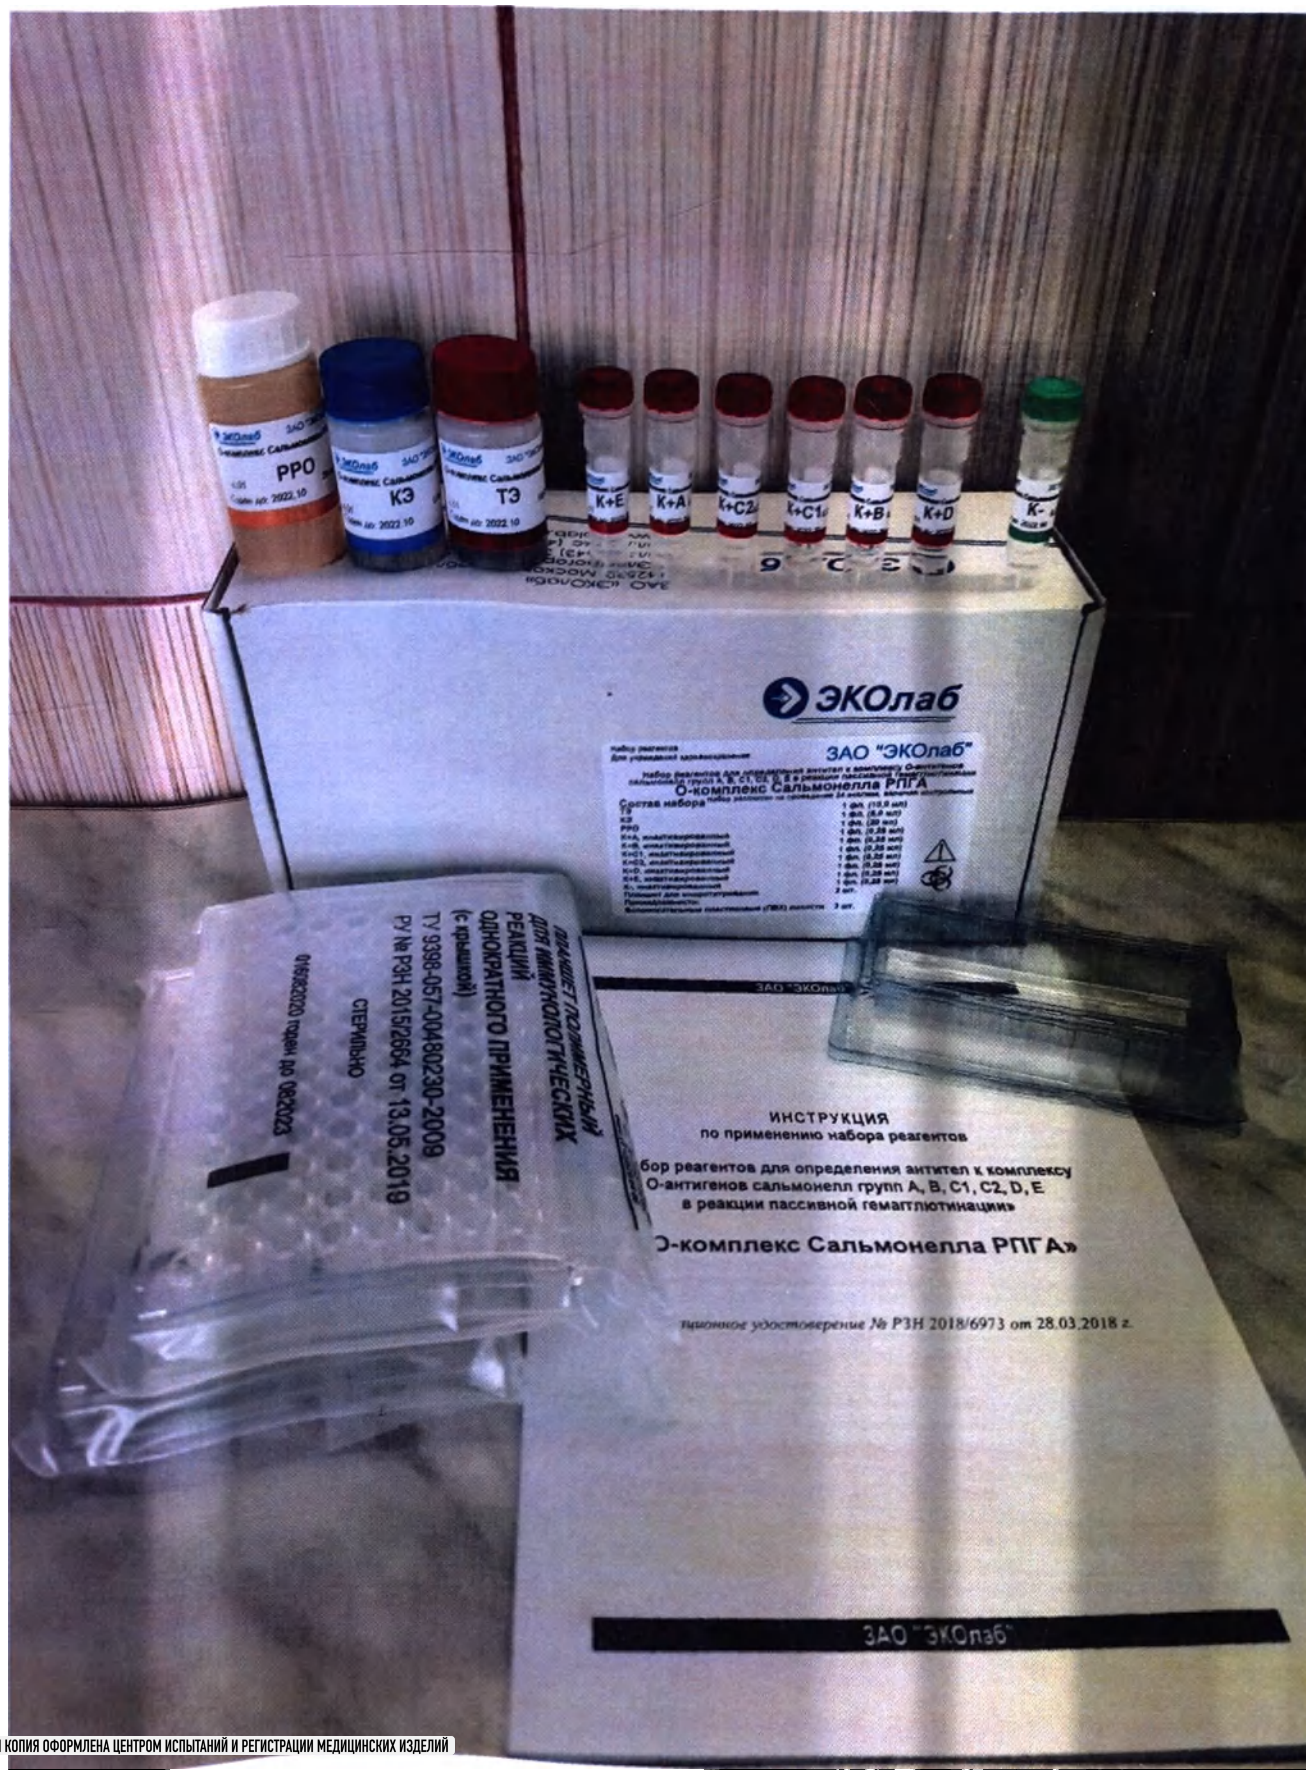

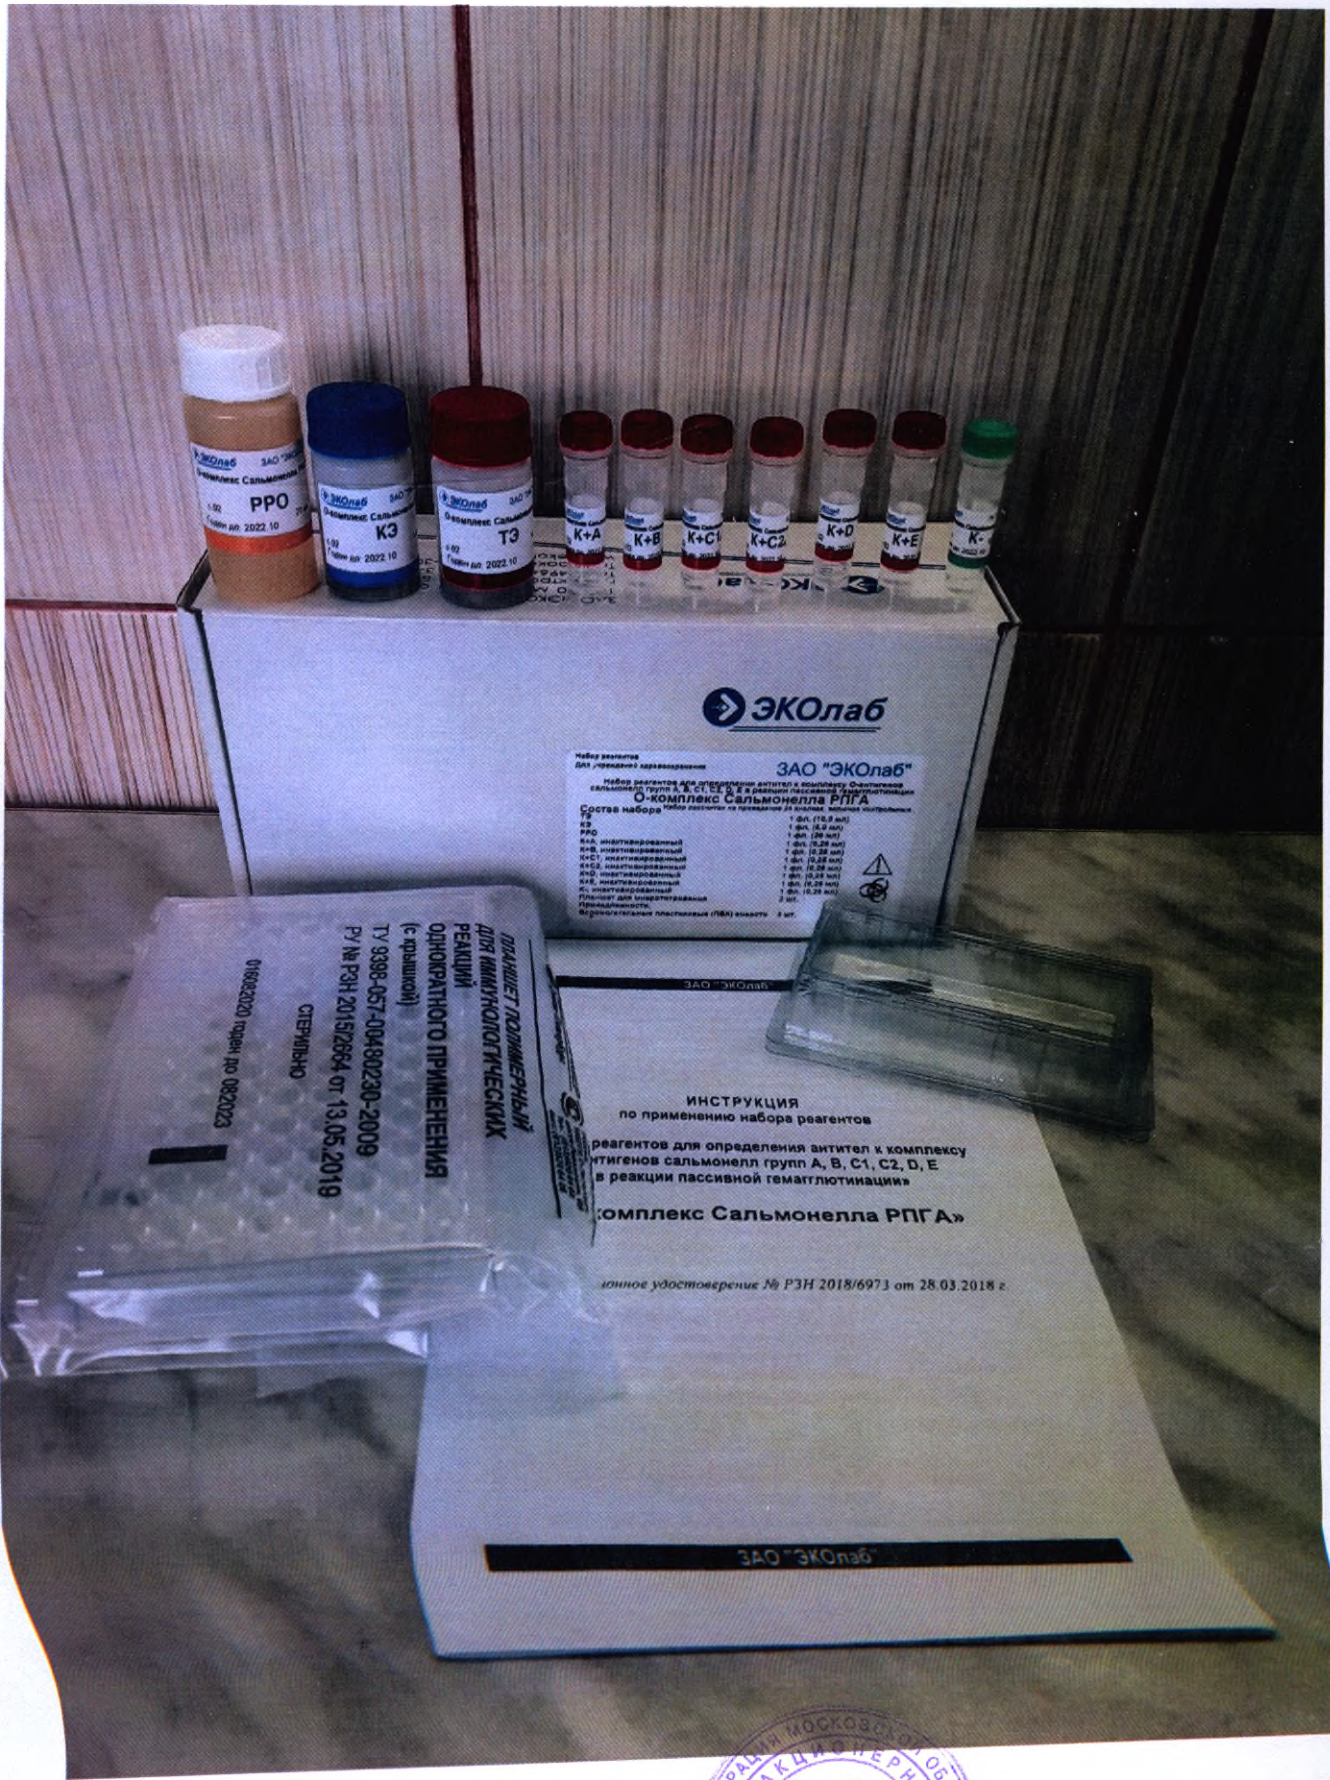

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а
Зам Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.
"05" 07 2021 г.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов
« 01 » 2021 г.

Комплект этикеток «О-комплекс Сальмонелла РПГА»

лабор реактивов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реактивов для определения антител к комплексу О-антигенов сальмонелл групп А, В, С1, С2, D, Е в реакции пассивной гемагглютинации

О-комплекс Сальмонелла РПГА


Набор рассчитан на проведение 24 анализа, включая контрольные

Состав набора

ТЭ	1 фл. (10,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (20 мл)
(+А, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(+В, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(+С1, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(+С2, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(+D, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(+Е, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
(-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	2 шт.

Принадлежности:

испомогательные пластиковые (ПВХ) емкости 3 шт.



ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

У 21.20.23.110-247-70423725-2017 с изм. № 1, № 2

У № РЗН 2018/6973 от 28.03.2018

Каталожный № 42.03

Серия 01 Контрольный № 65

Дата изготовления: 2021.02.24

Годен до: 2022.10.24



ЗАО "ЭКОлаб"
О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
РРО
20 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб"
О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
КЭ
5,0 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
ТЭ
10,0 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+А
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+В
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+С1
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+С2
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+D
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К+Е
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

О-комплекс Сальмонелла РПГА

с.01
К-
0,25 мл
Годен до: 2022.10



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор