

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой "Armed" в вариантах исполнения»,
производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.), Китай

- I. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M102 (см. Приложение).
- II. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M103 (см. Приложение).
- III. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M104 (см. Приложение).
- IV. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M118 (см. Приложение).
- V. Макет этикетки (см. Приложение).
- VI. Макет упаковки (см. Приложение).

Генеральный директор

(должность)

(подпись и печать)



(Р.С. Жуков)

(И.О. Фамилия)

от имени _____ Общества с ограниченной ответственностью «Опора» (ООО «Опора»)
(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M102:

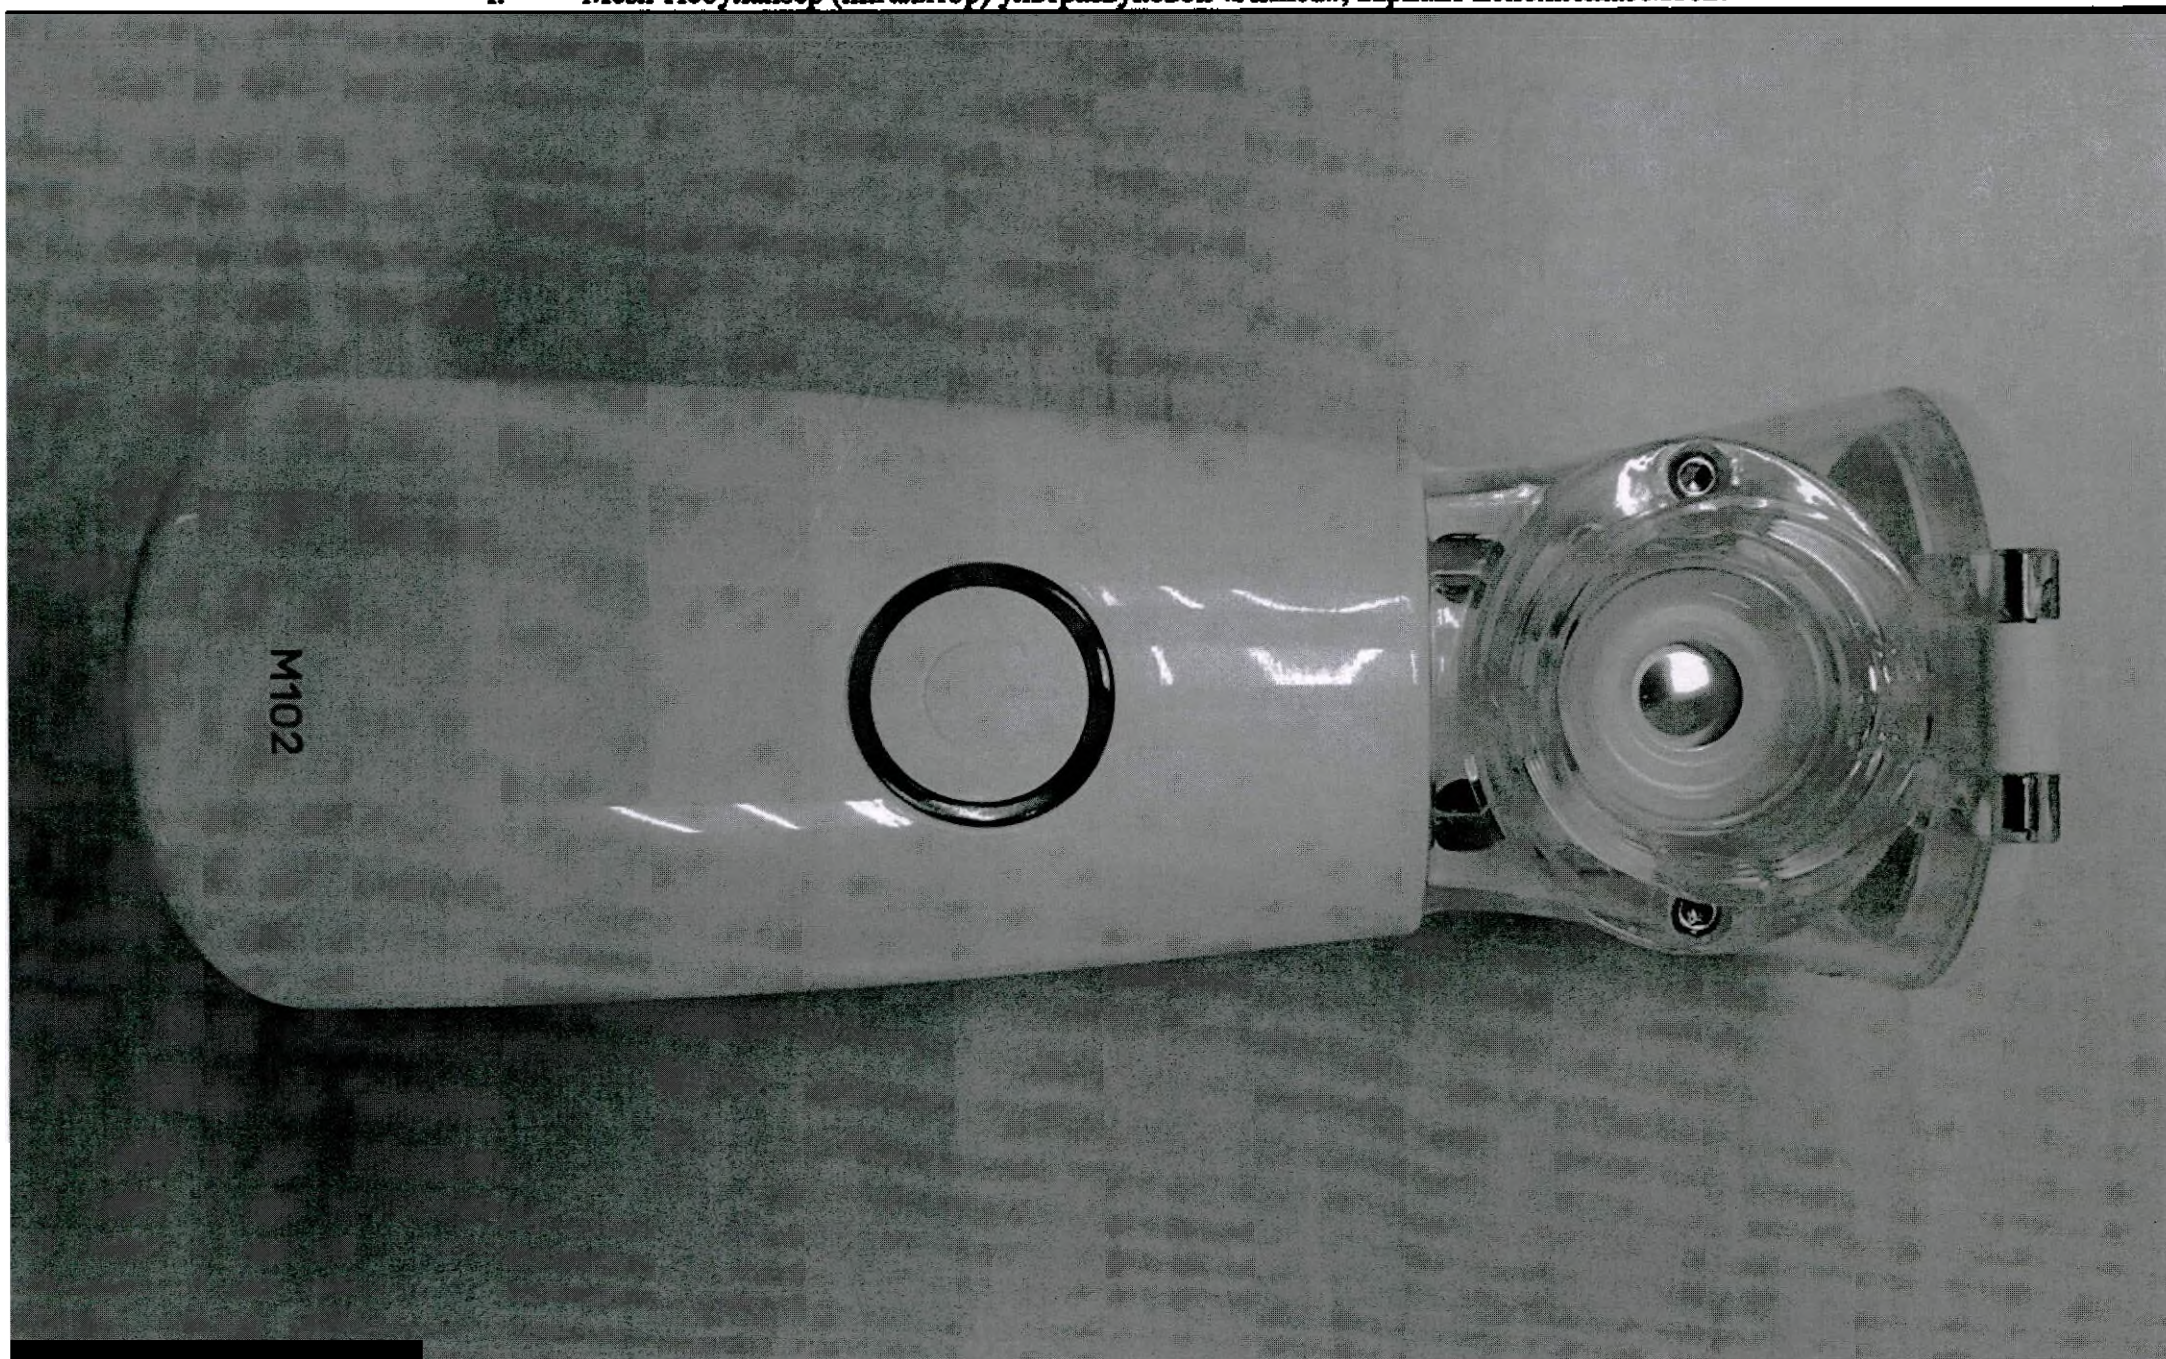
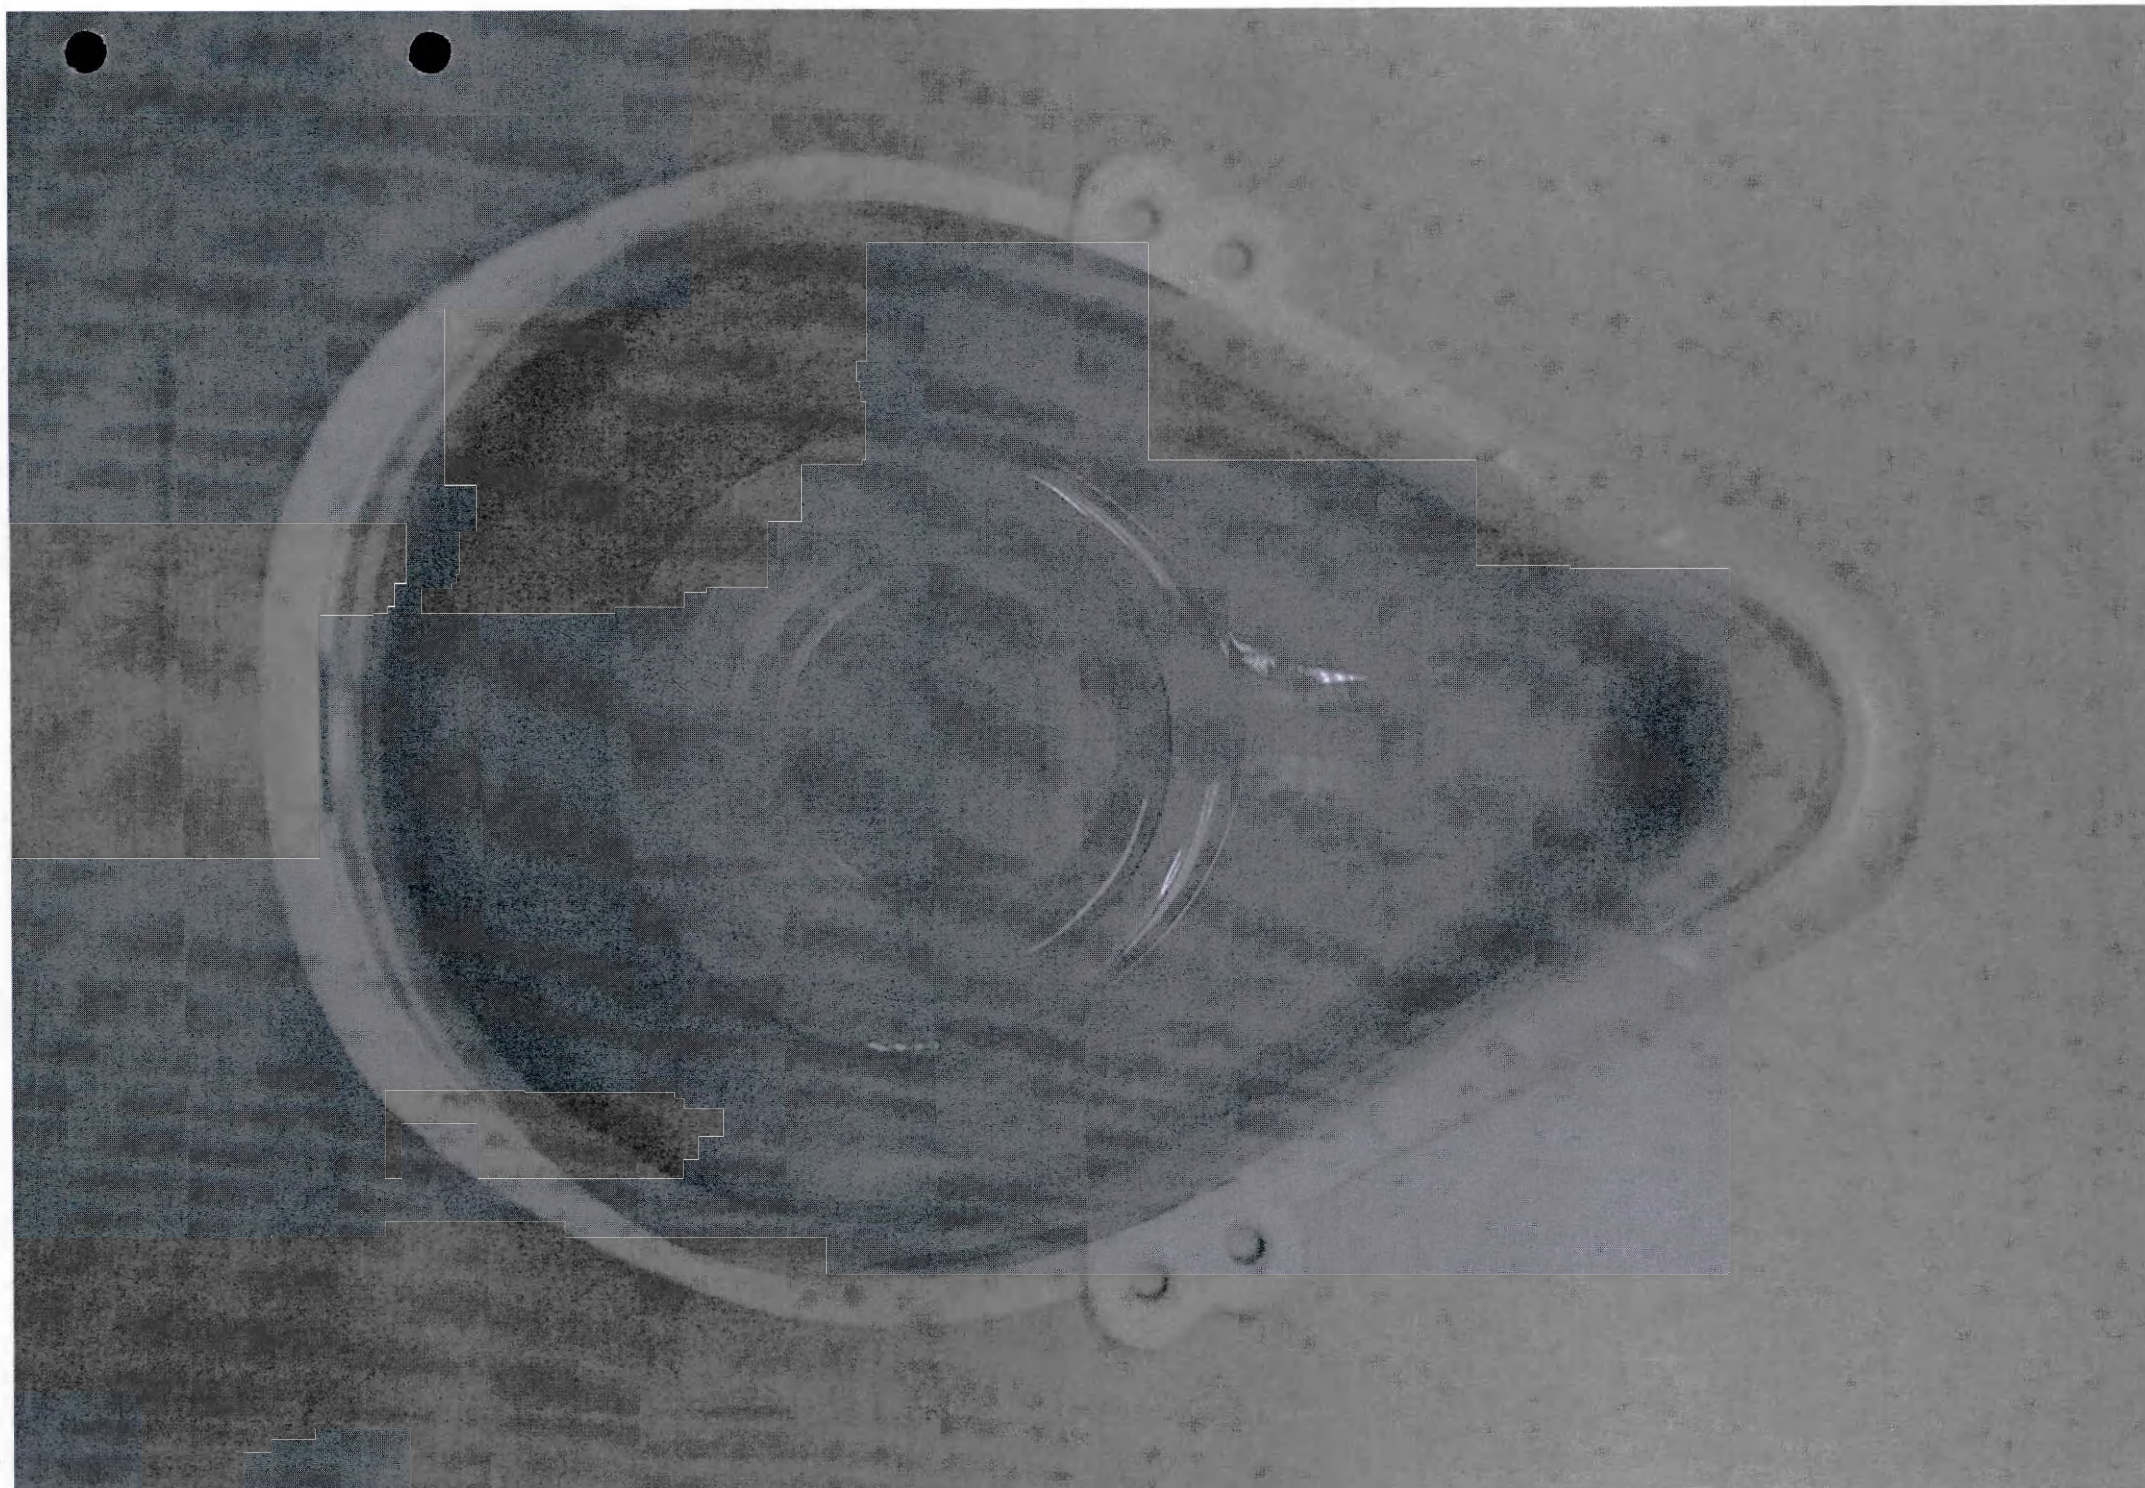


Рис. 1 – Базовый блок



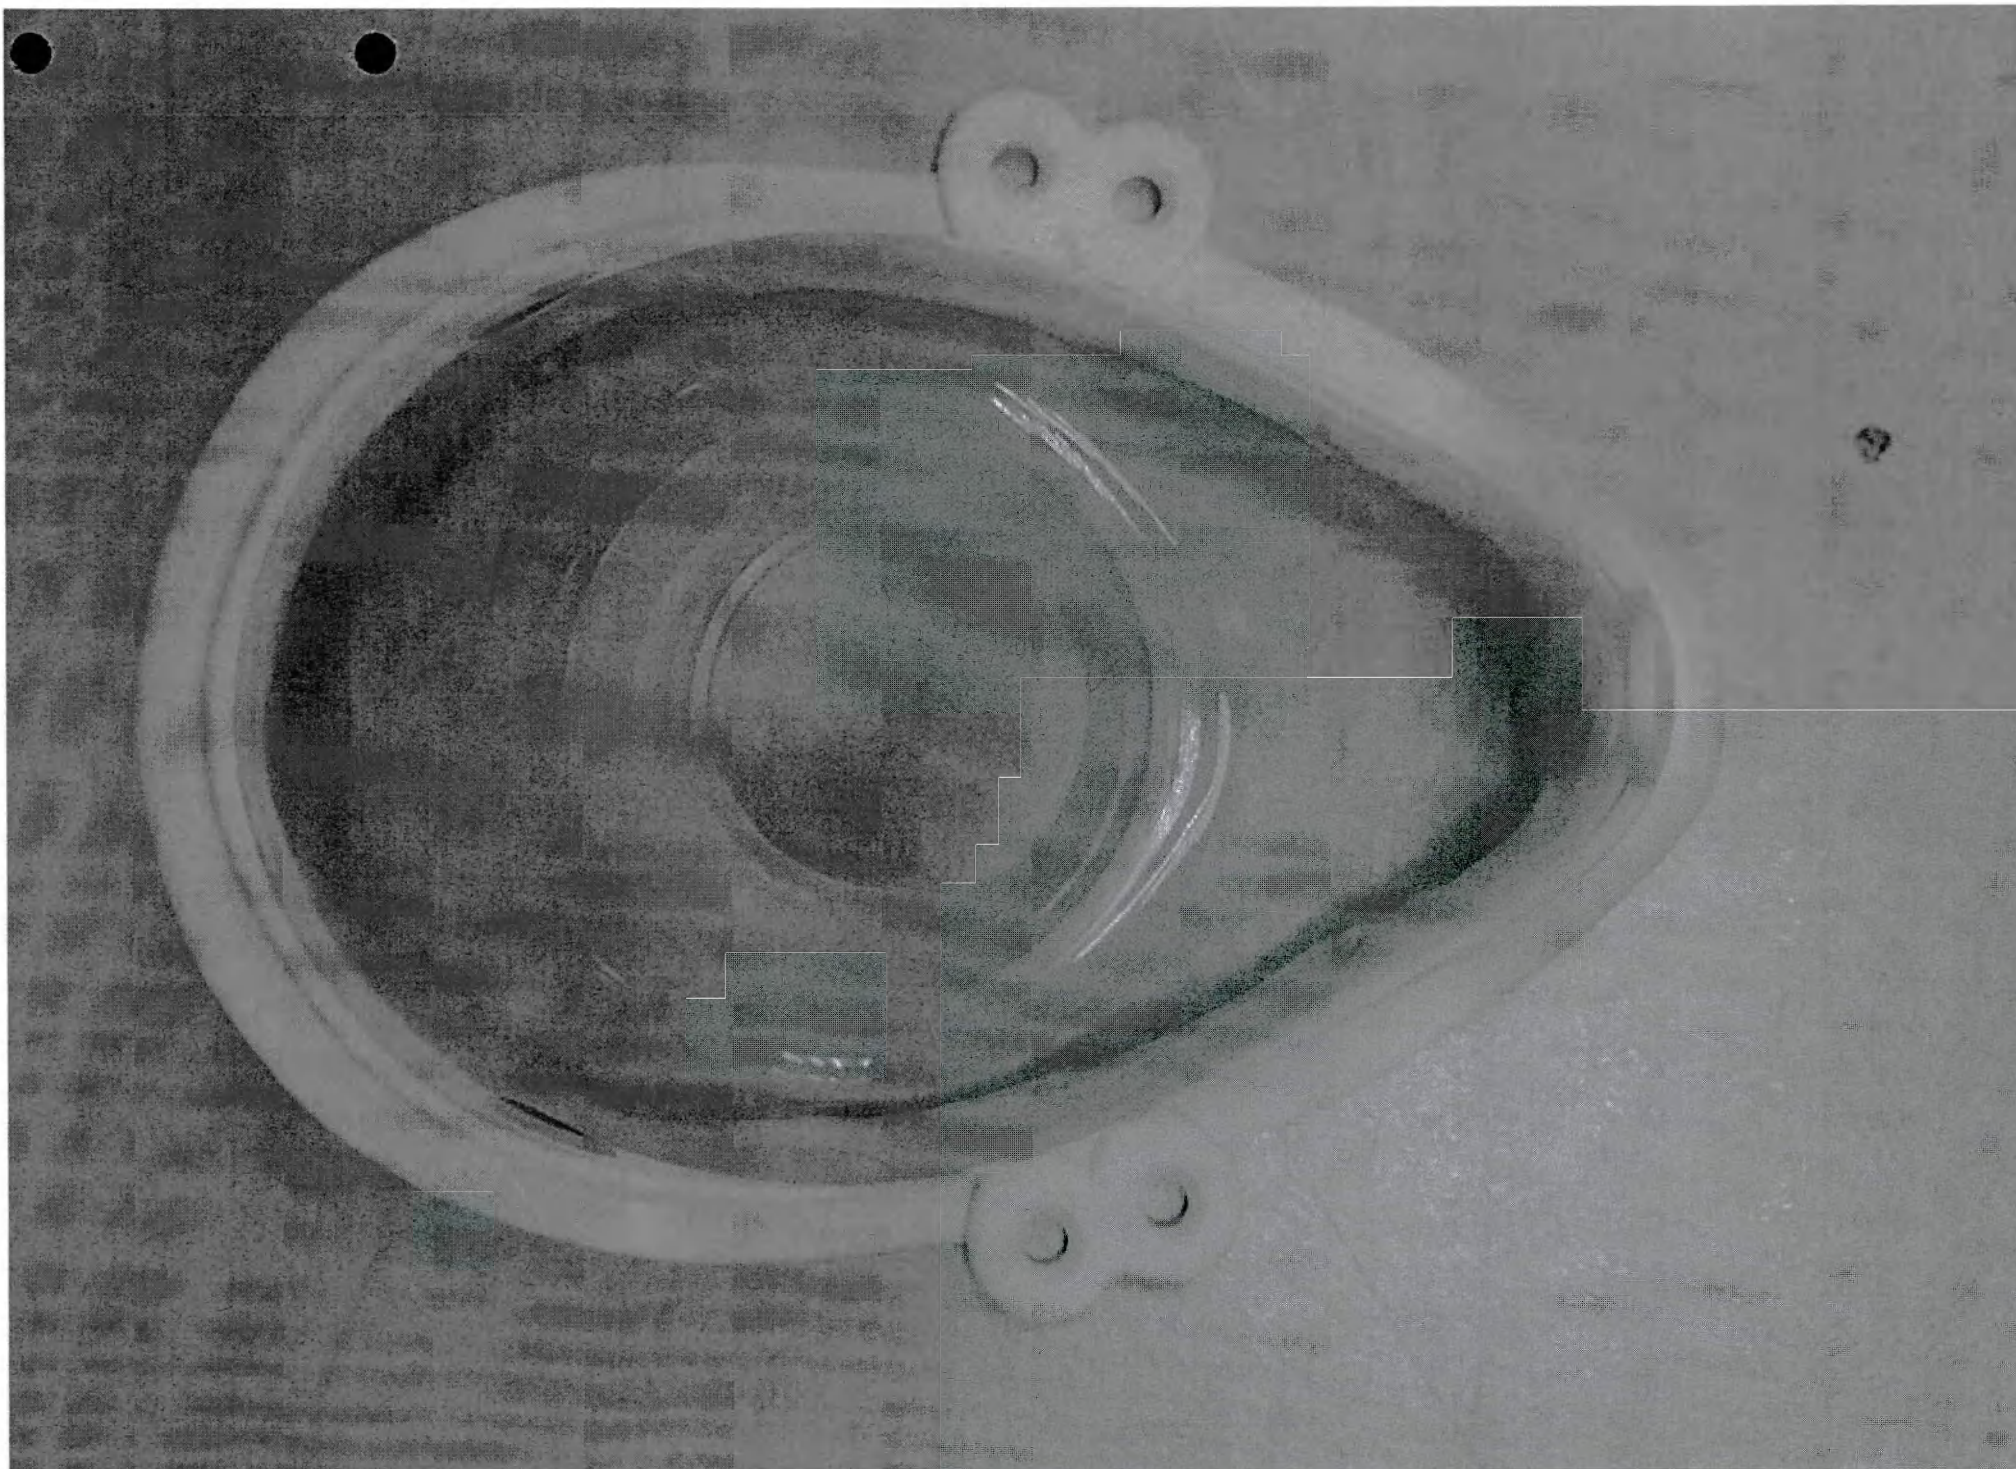


Рис. 3 - Маска ингаляционная, детская

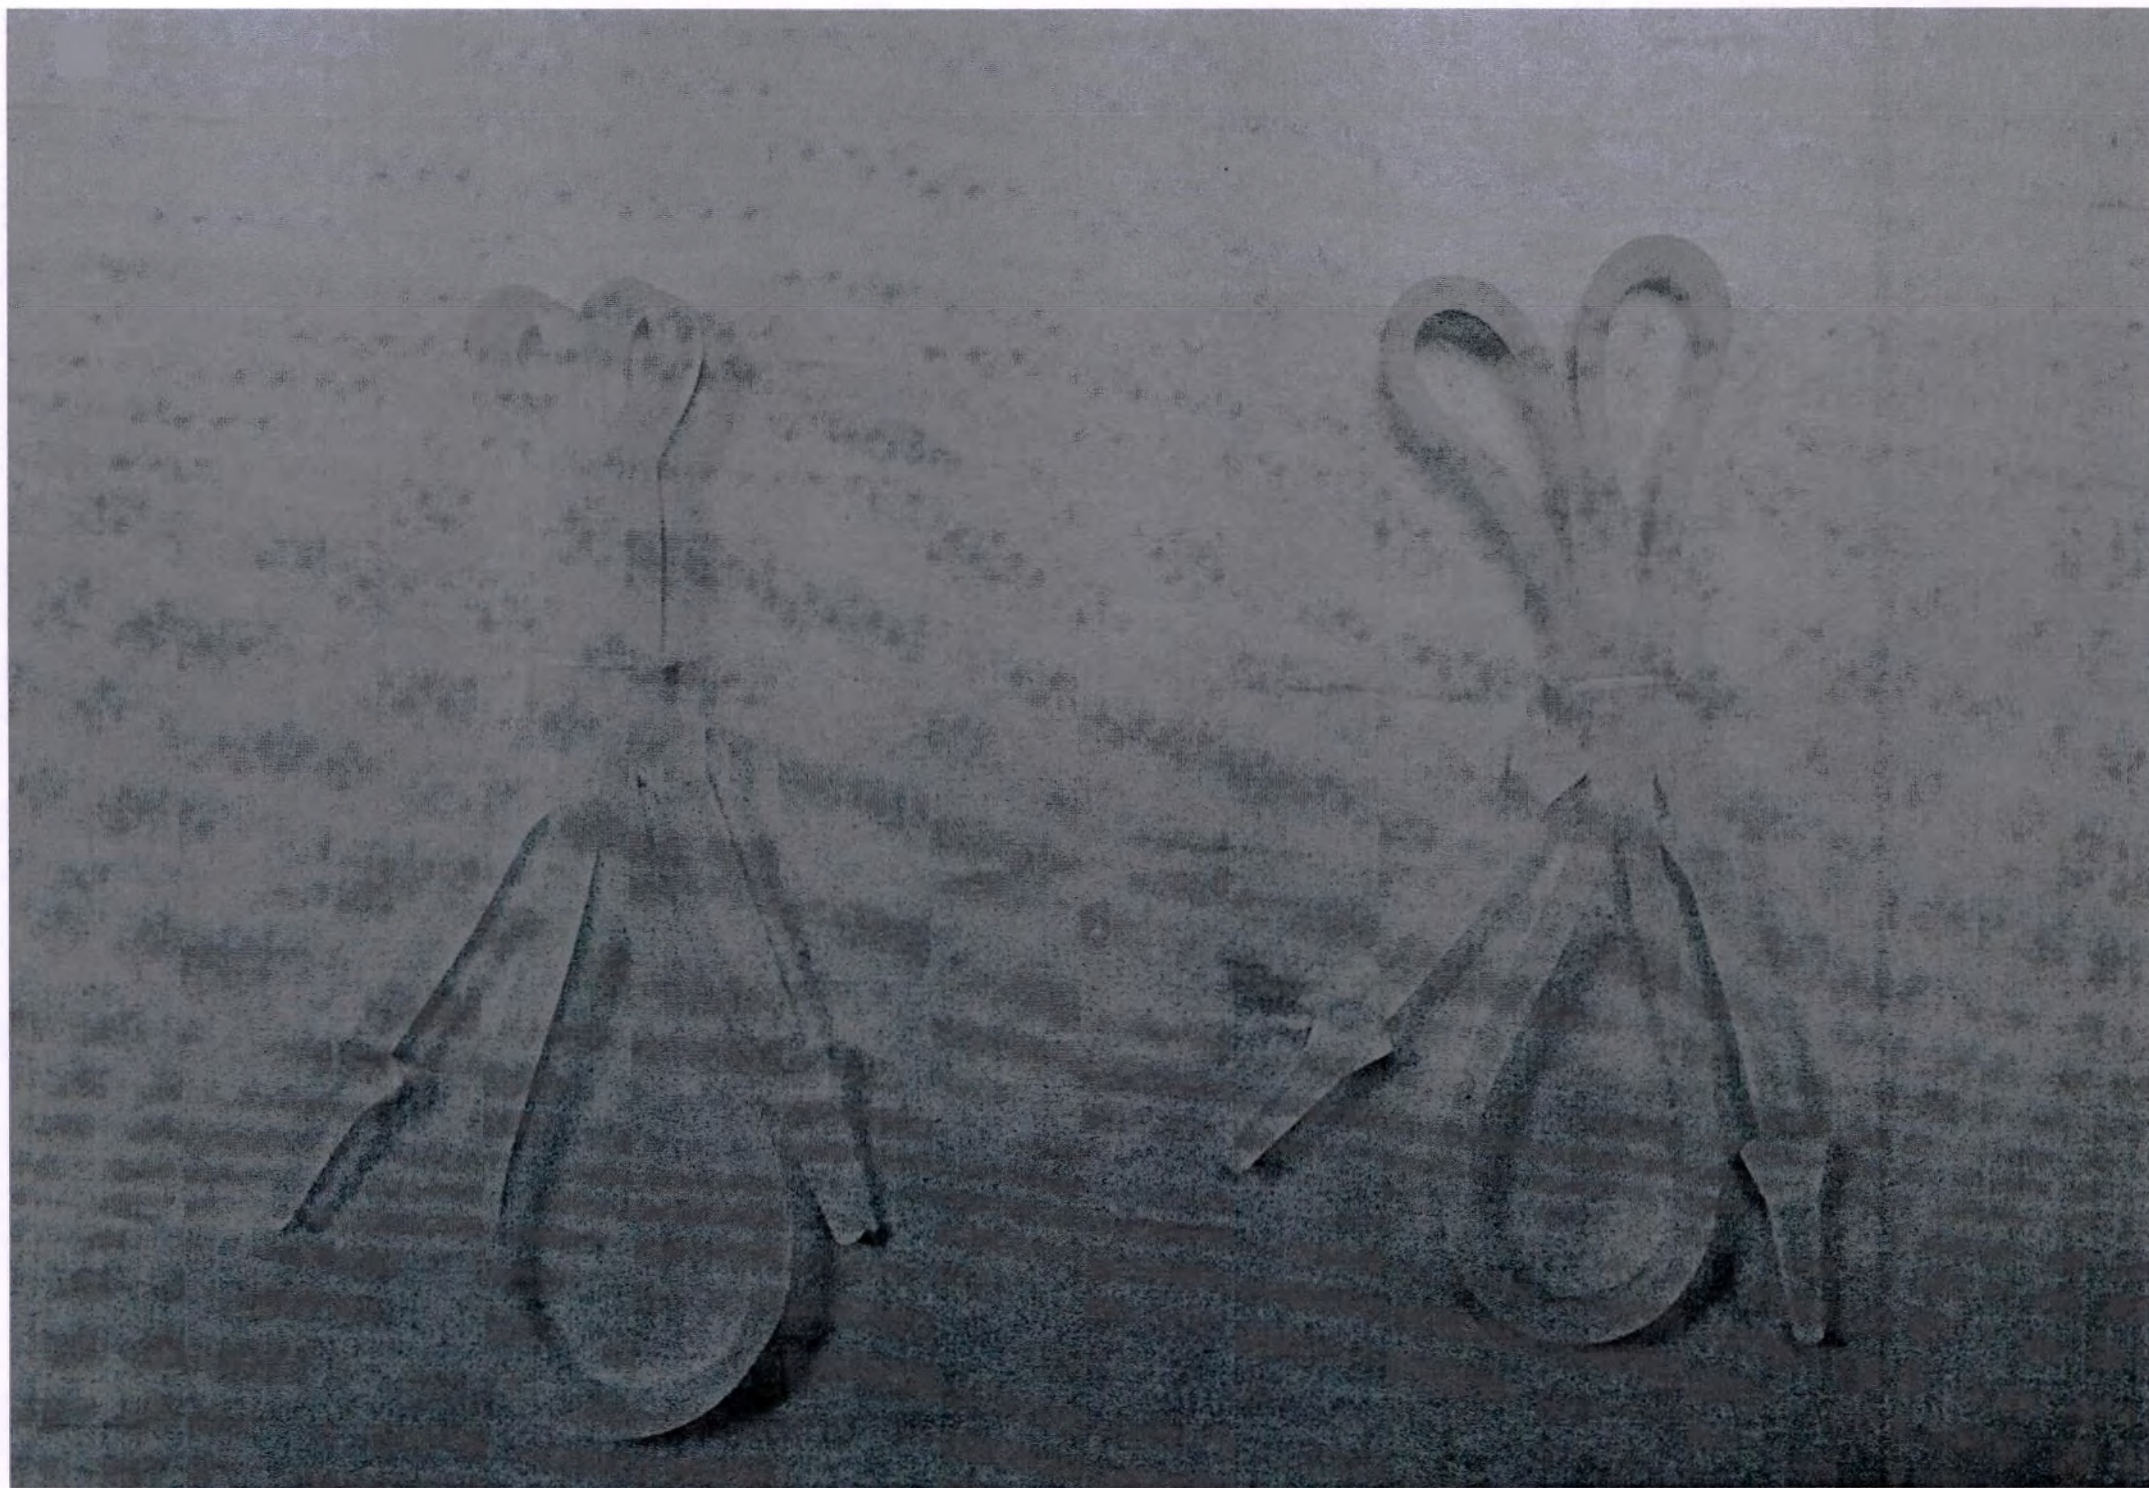


Рис. 4 - Держатель маски силиконовый (2 шт.)

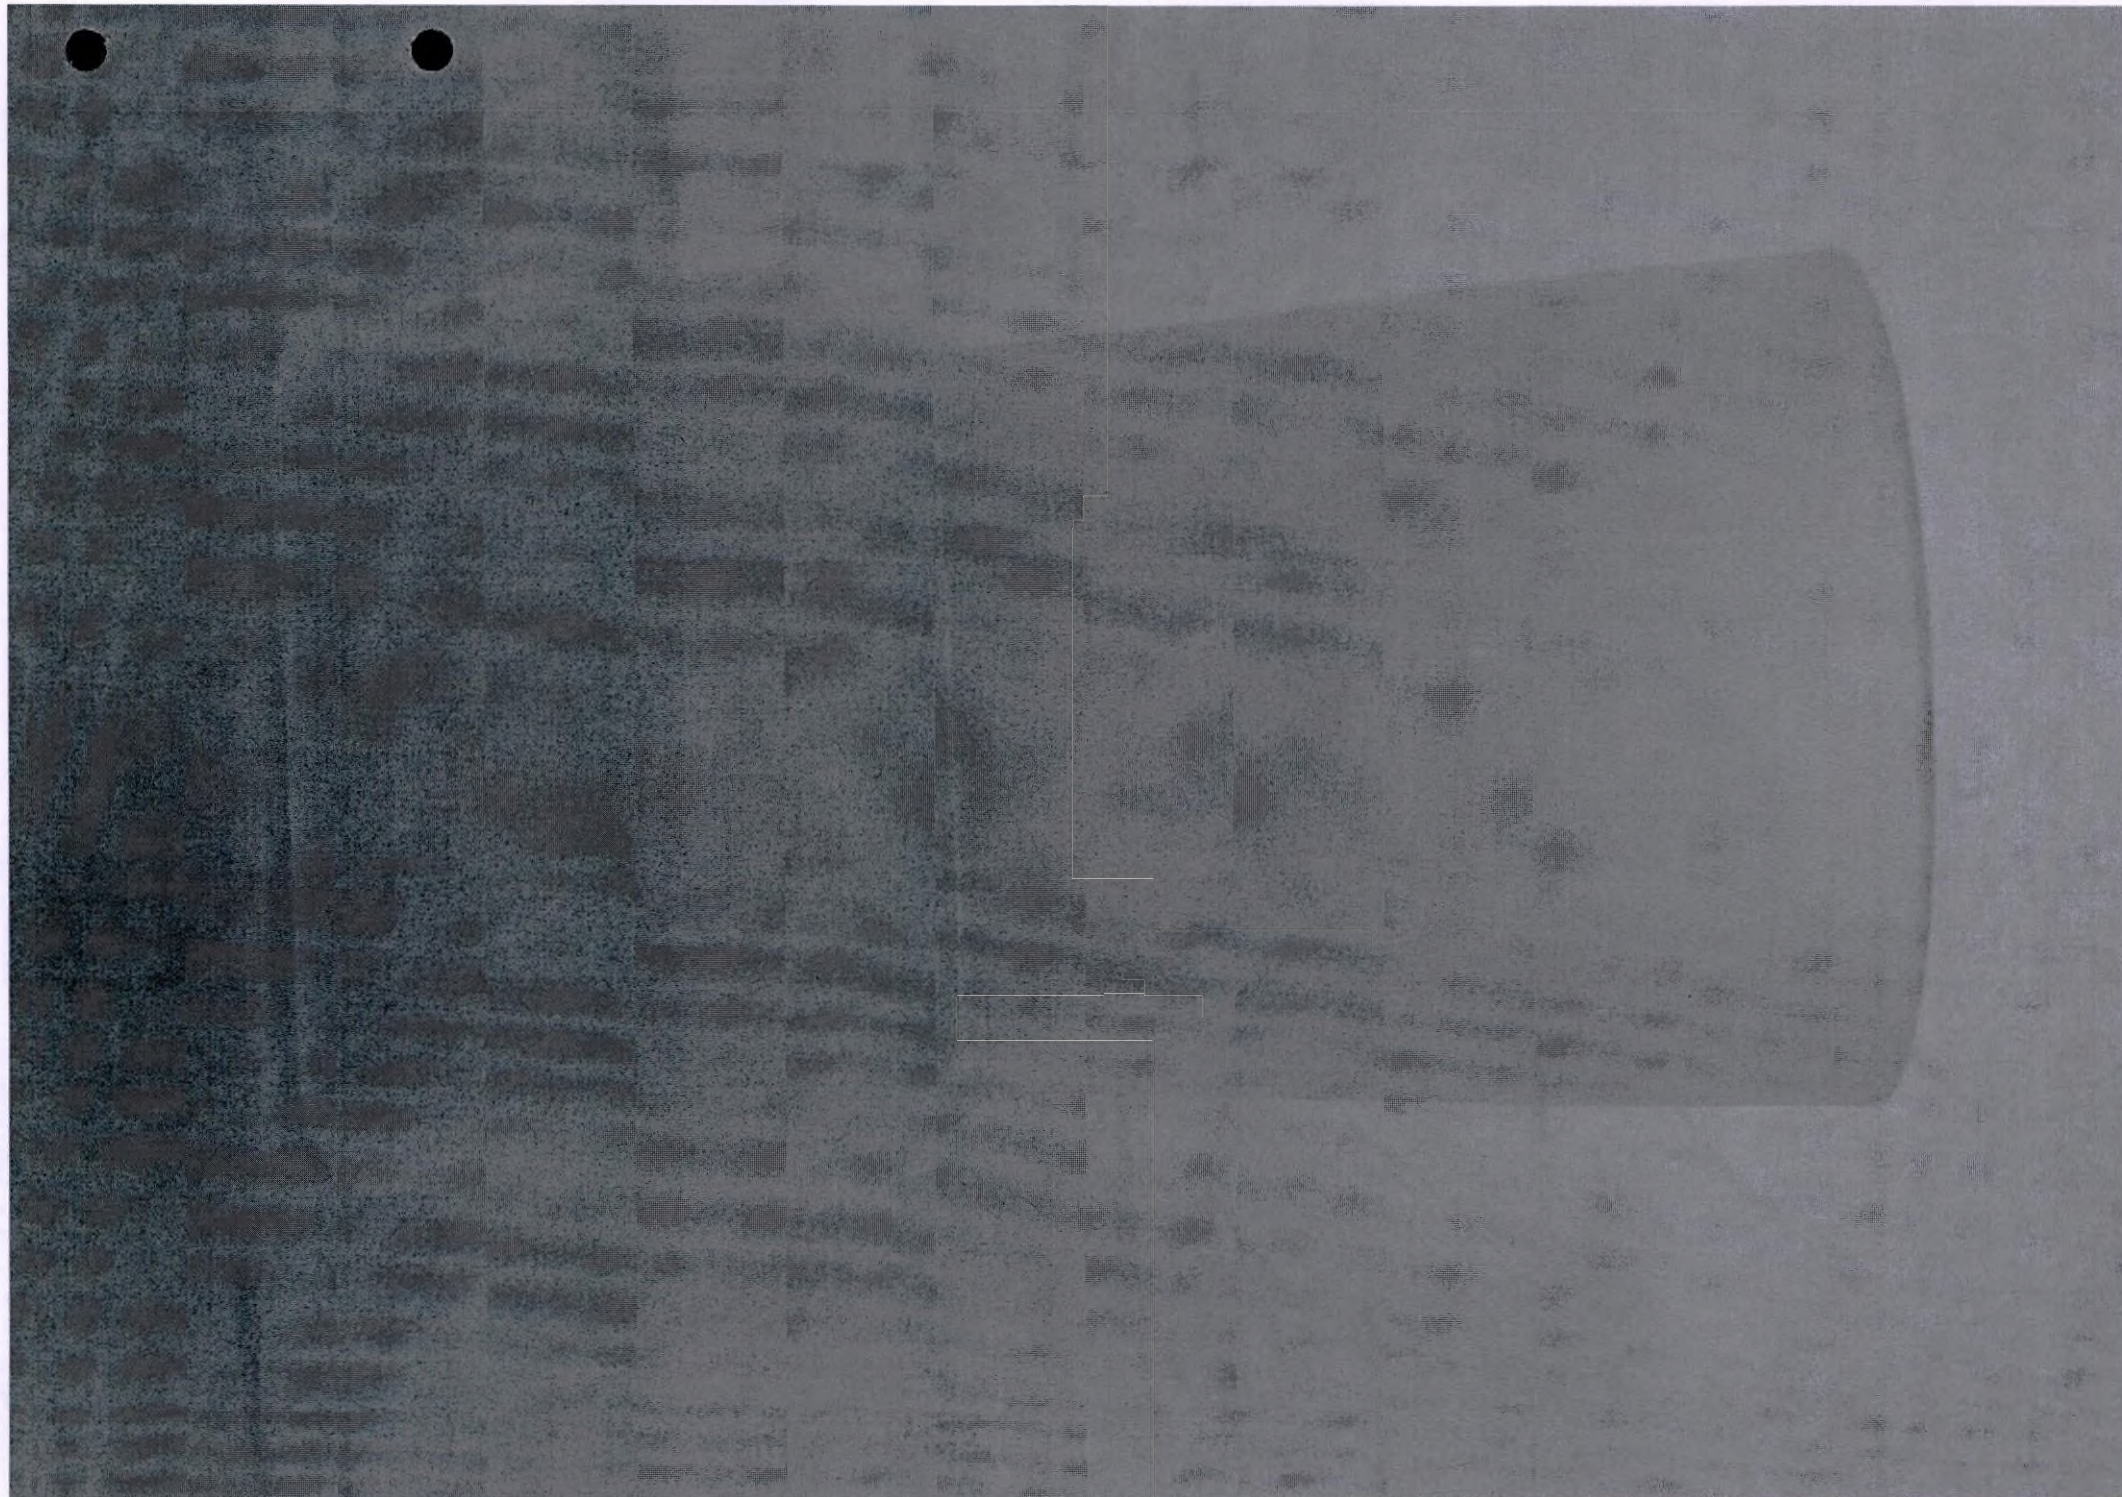




Рис. 6 – Элемент питания тип AA (2 шт.)

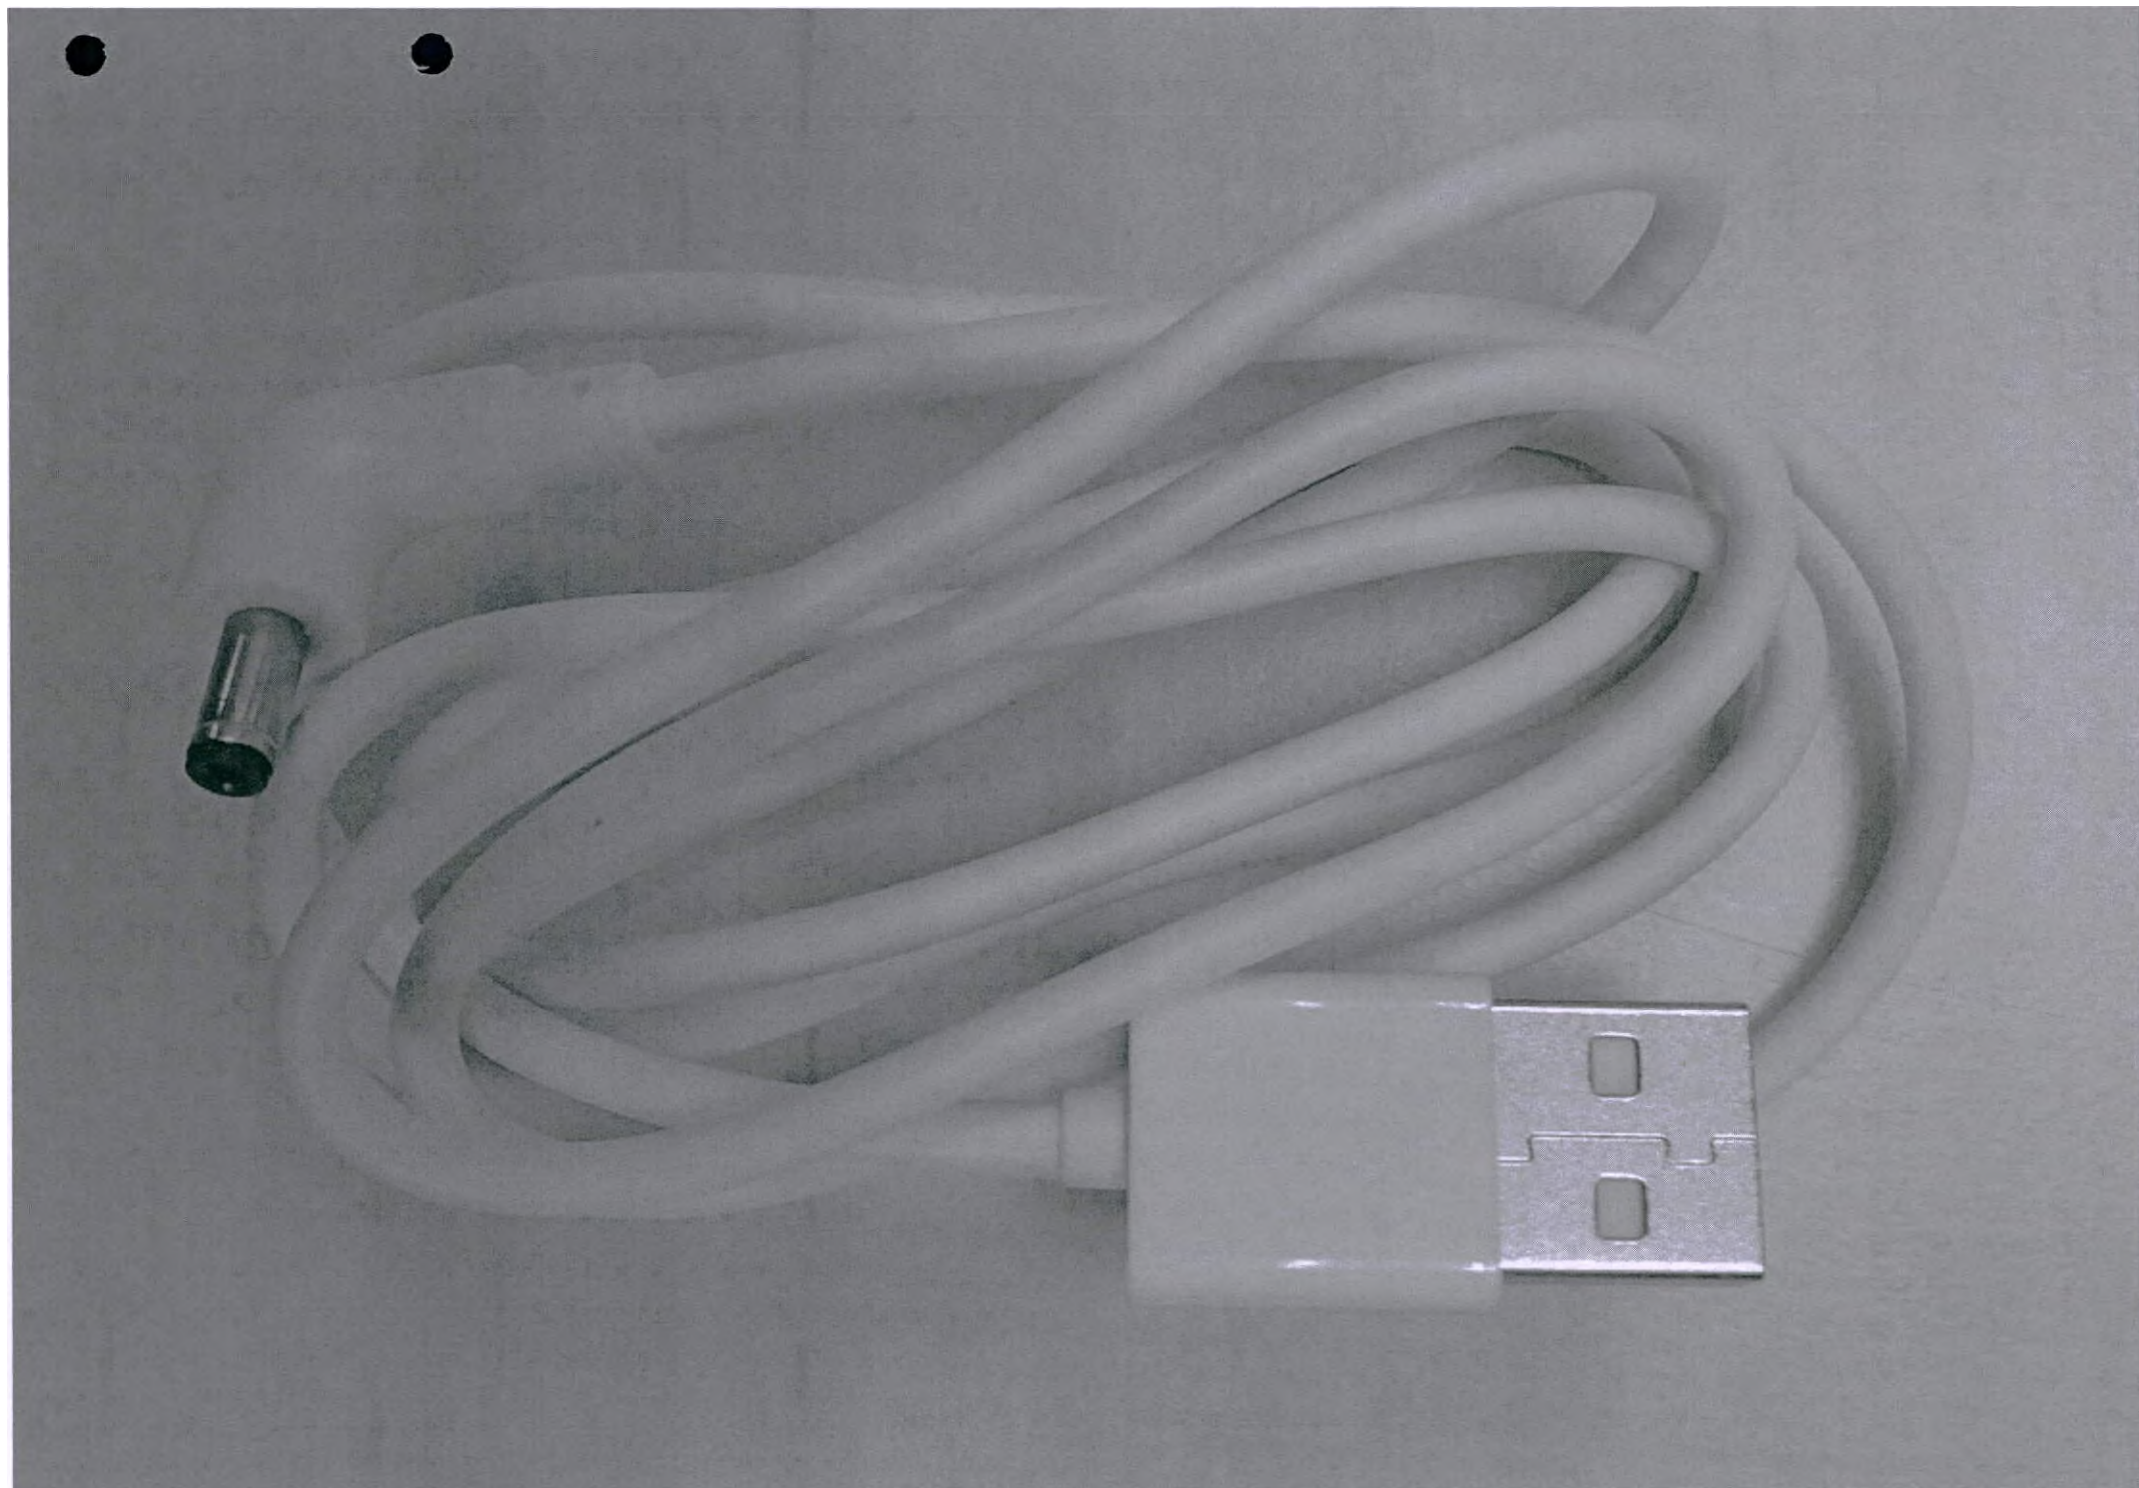


Рис. 7 – Кабель питания USB



II. Mesh-Небулайзер (ингалятор) ультразвуковой «Armed», вариант исполнения M103:

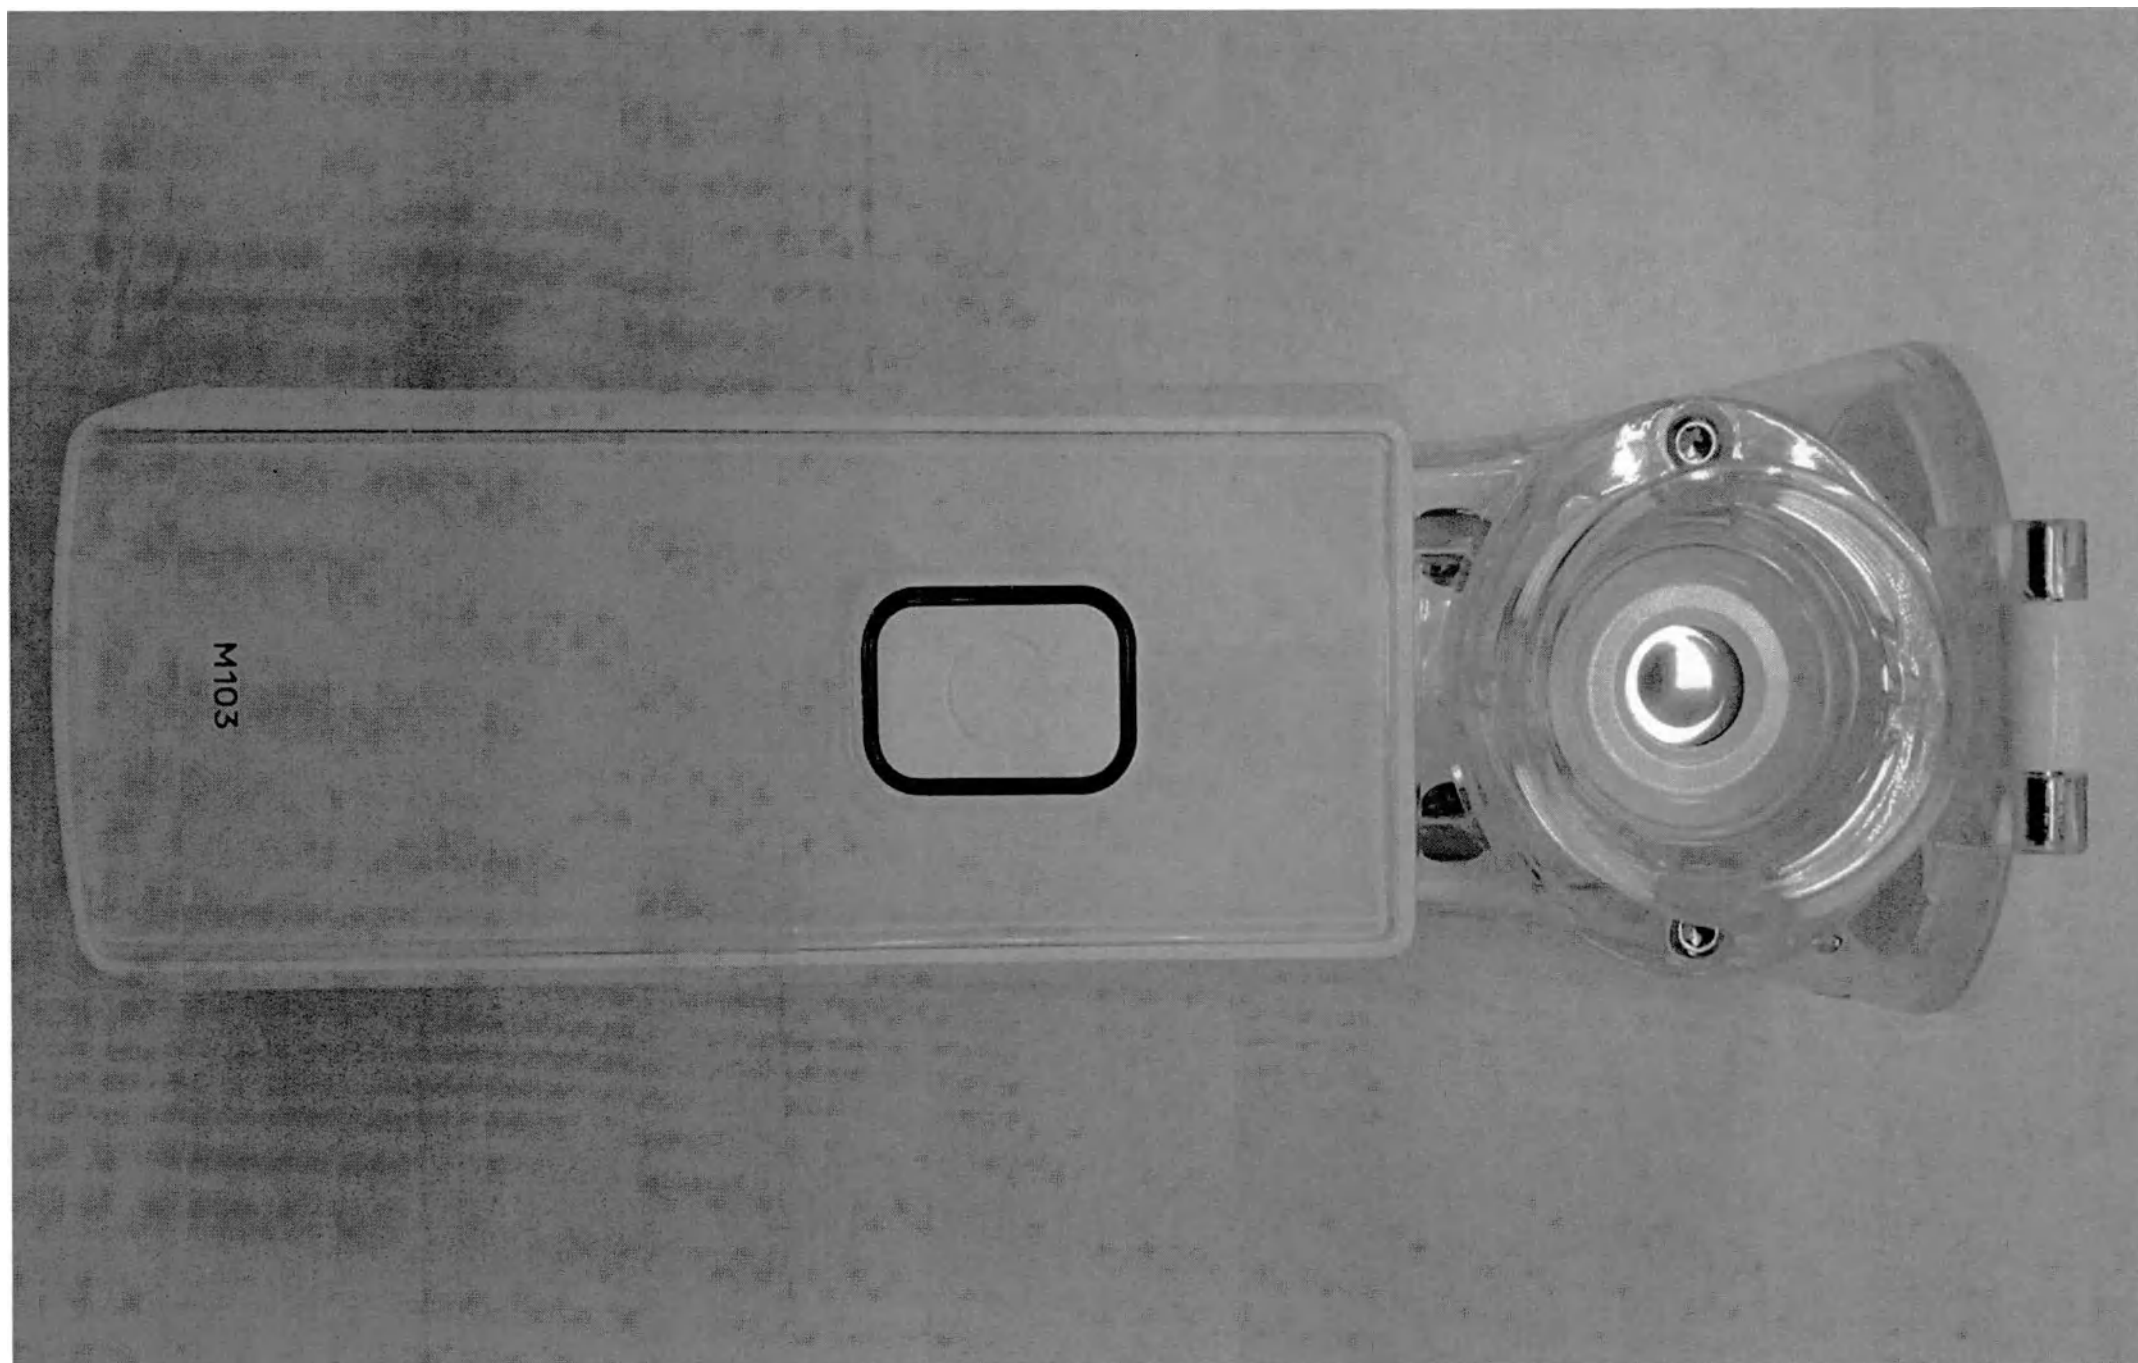
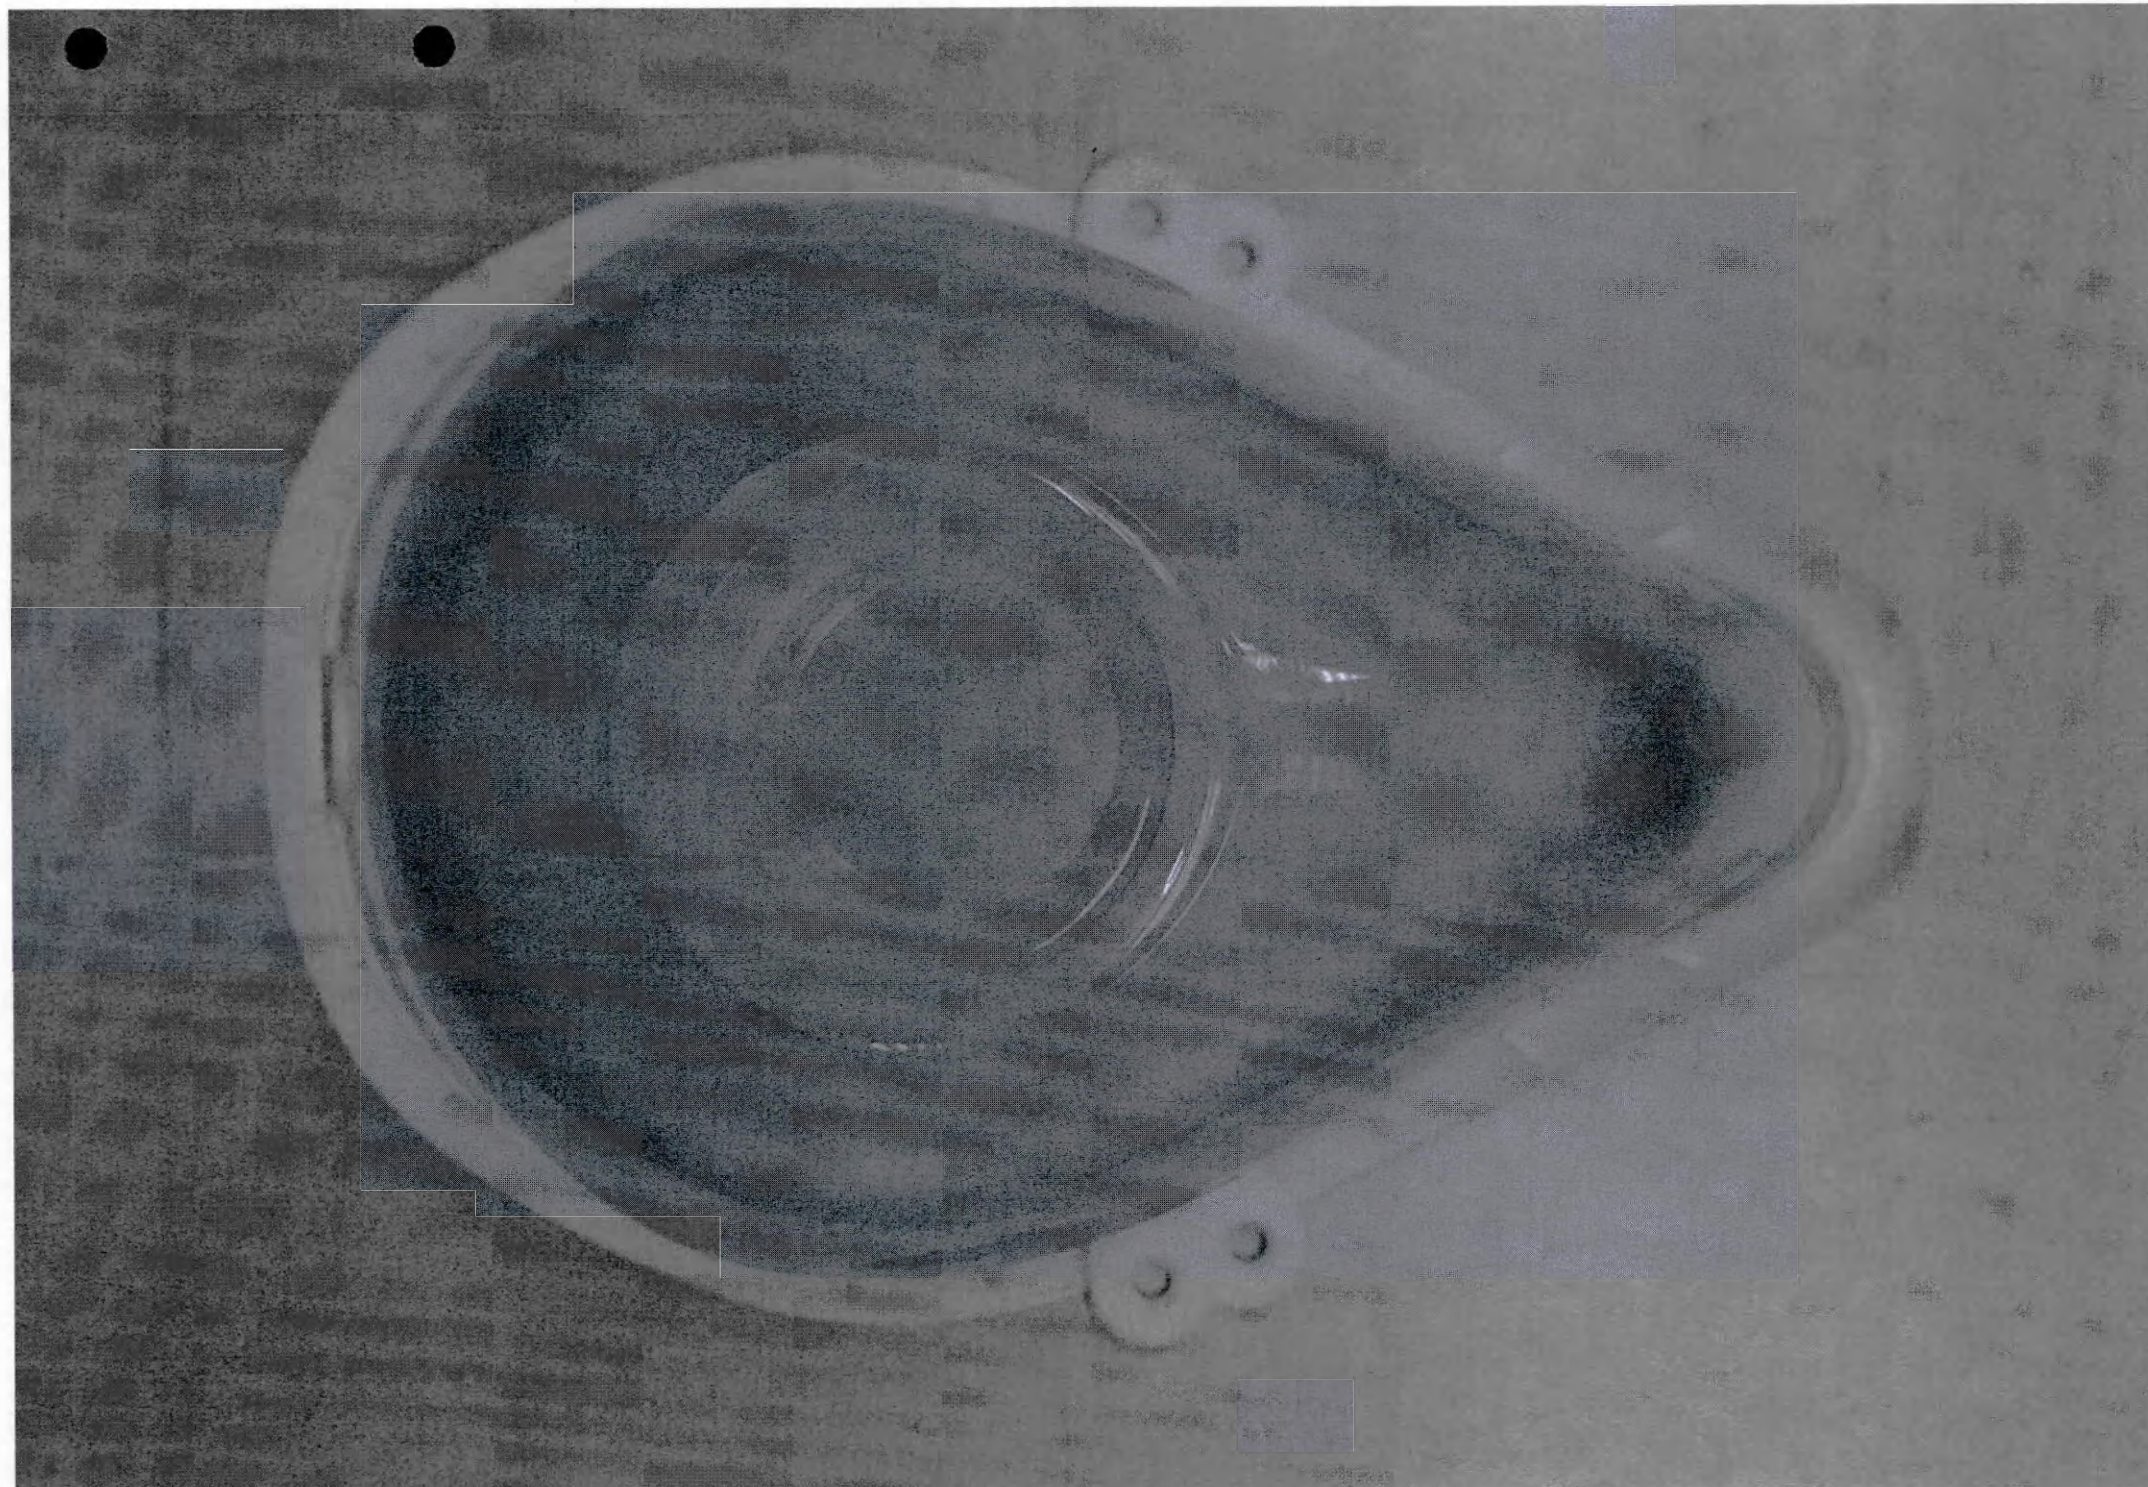
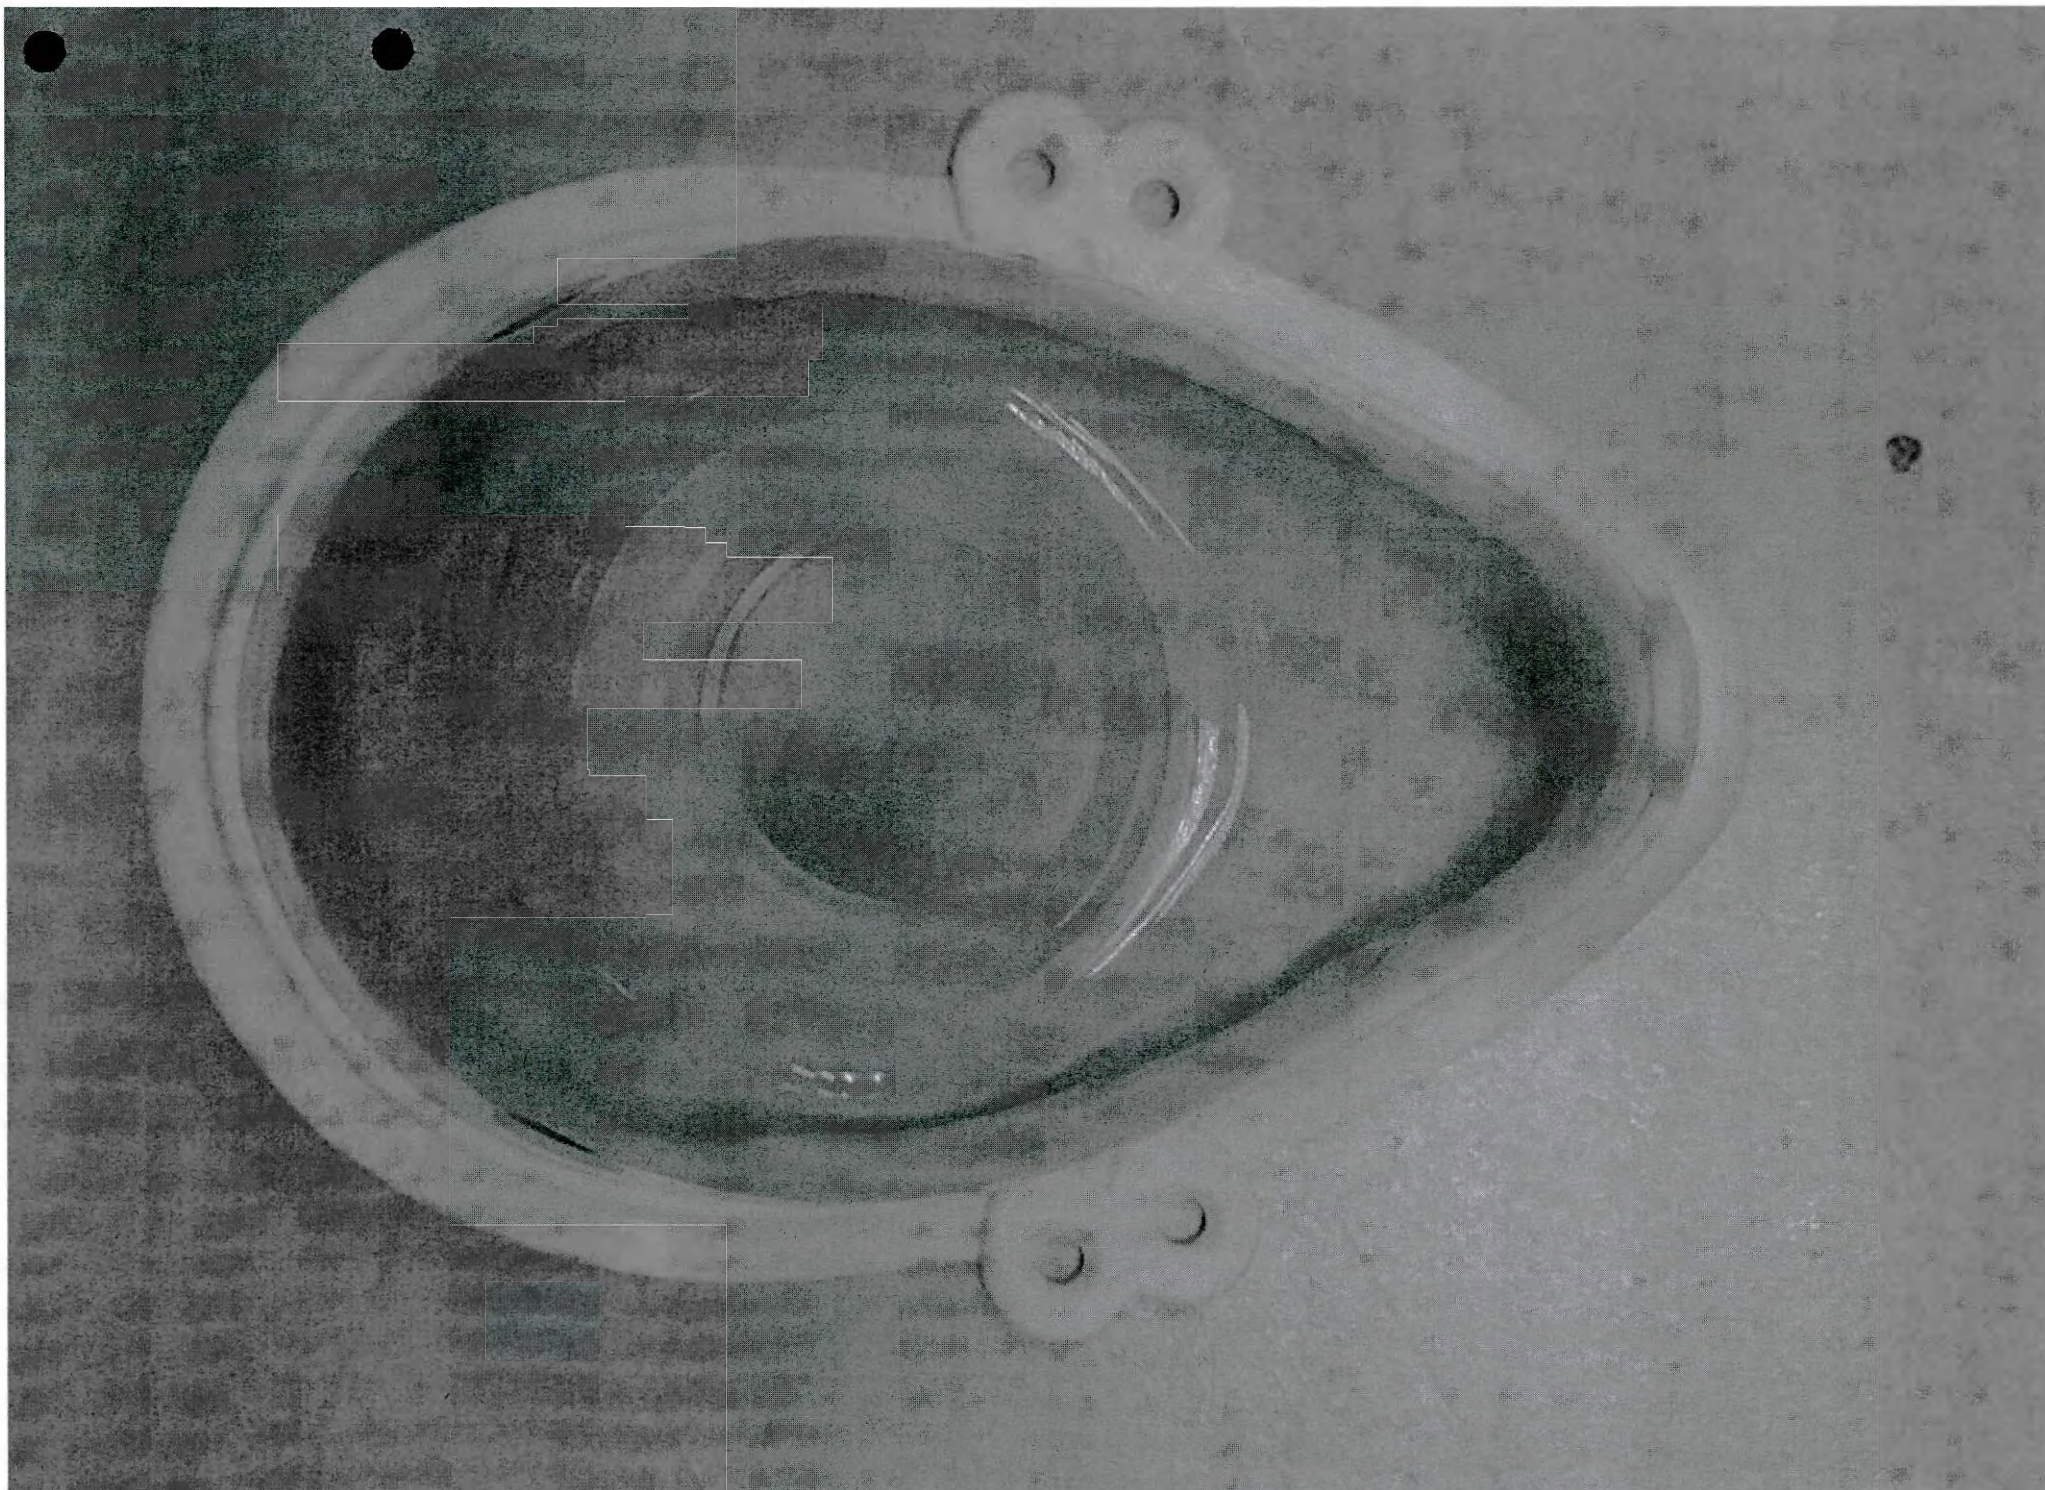


Рис. 9 – Базовый блок





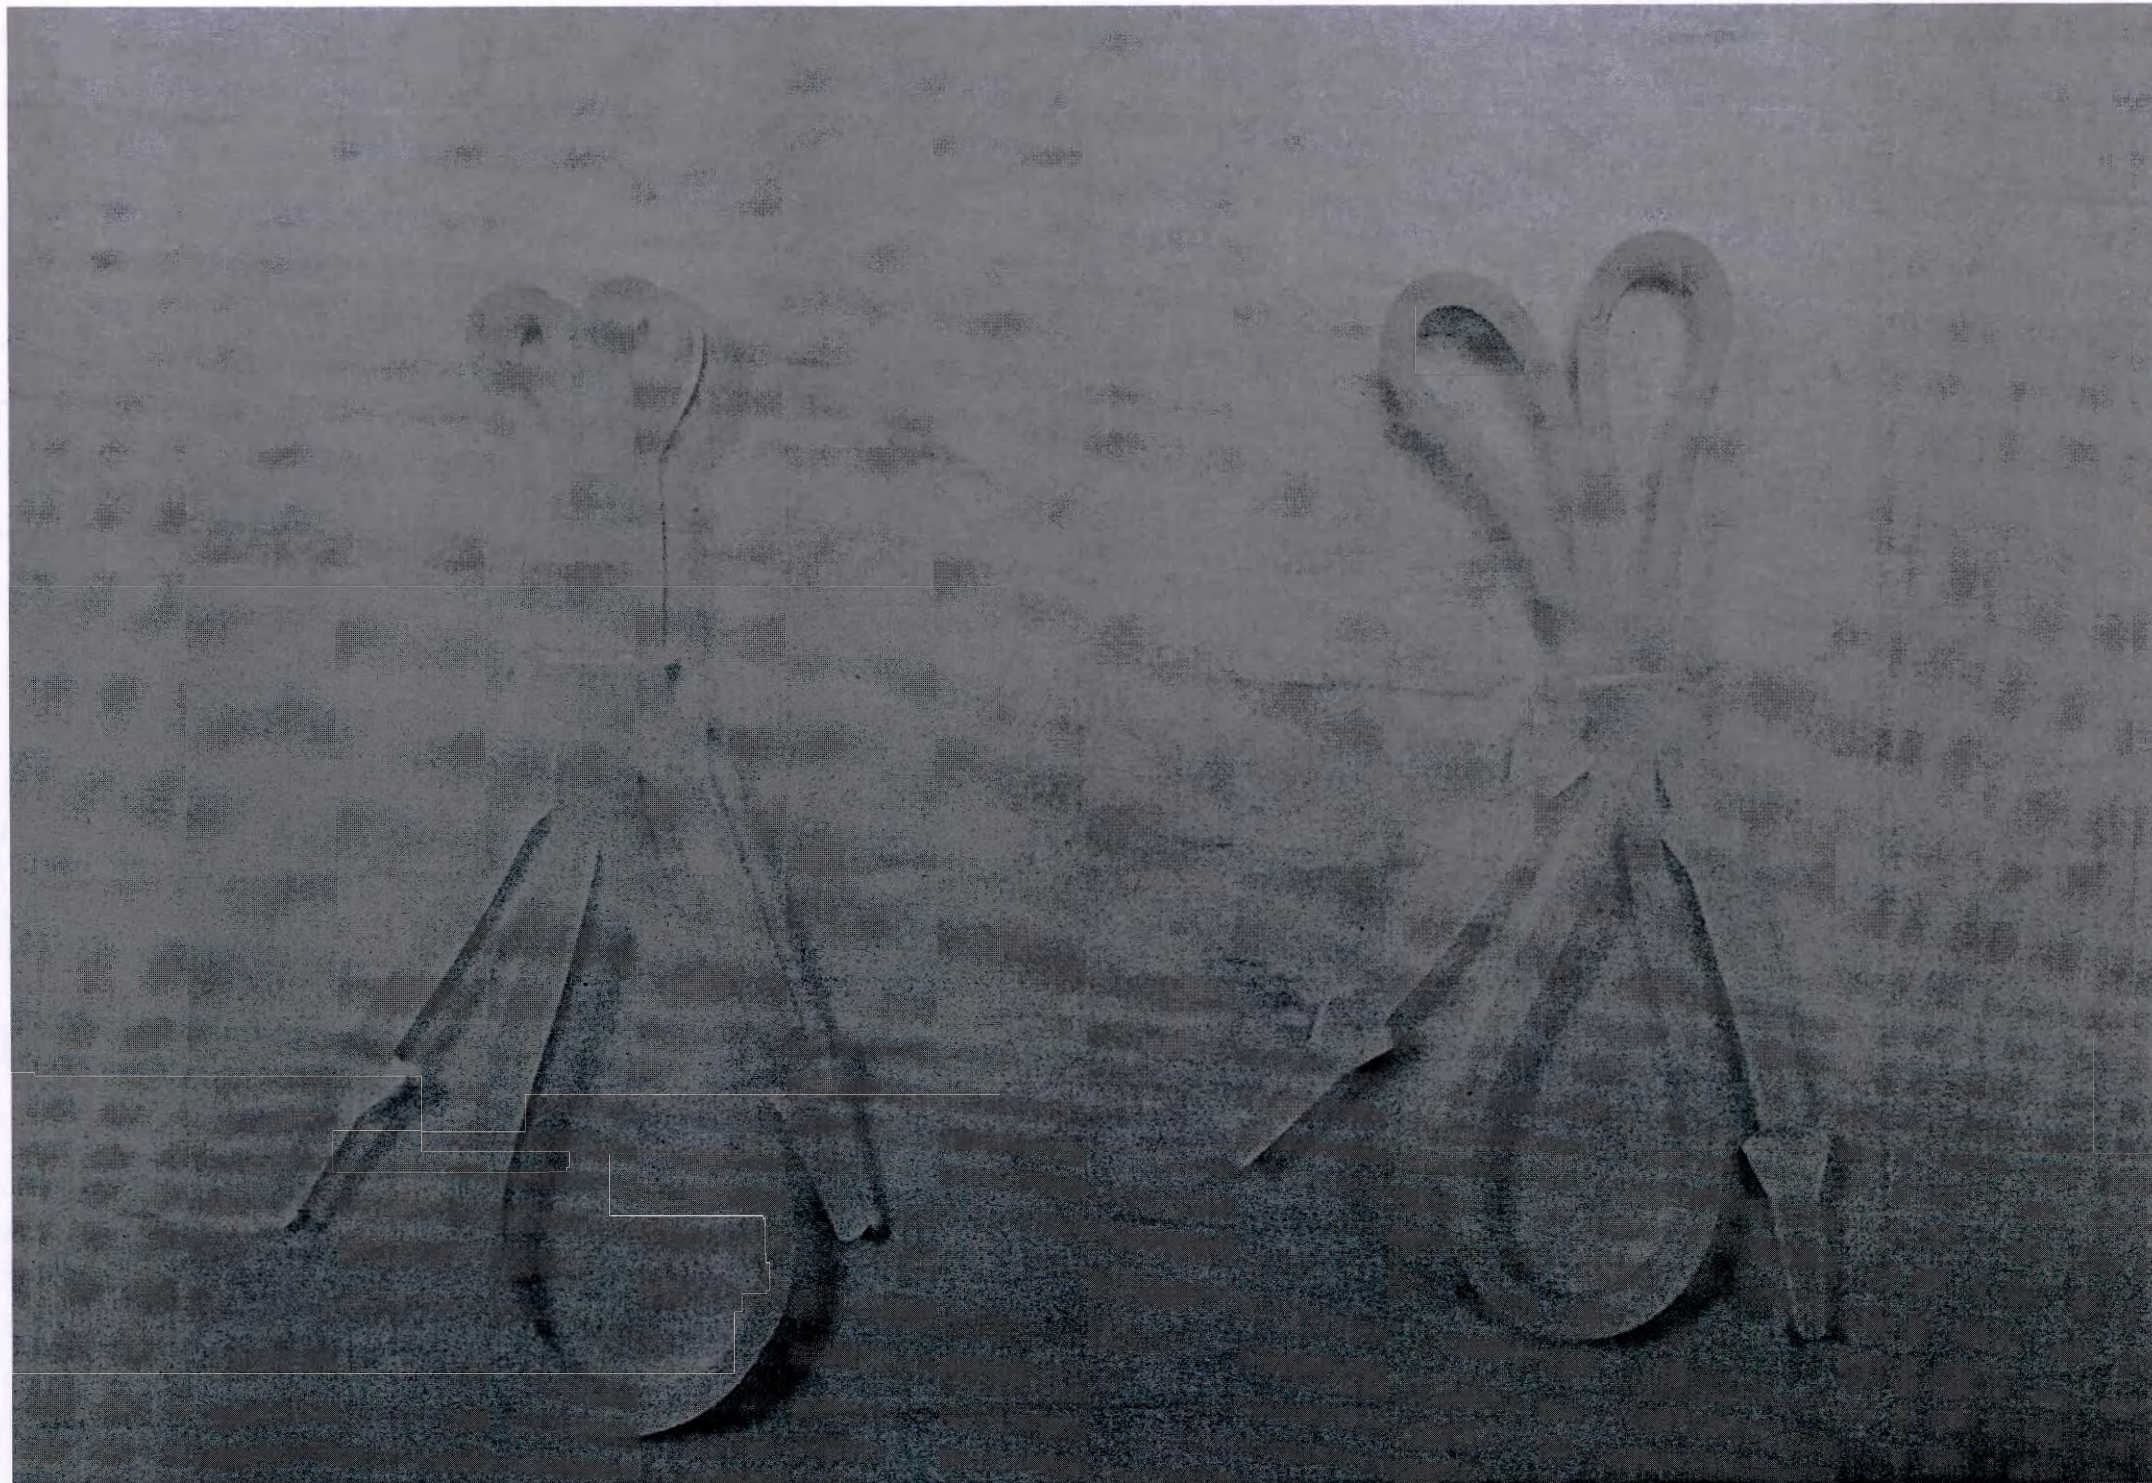


Рис. 12 - Держатель маски силиконовый (2 шт.)

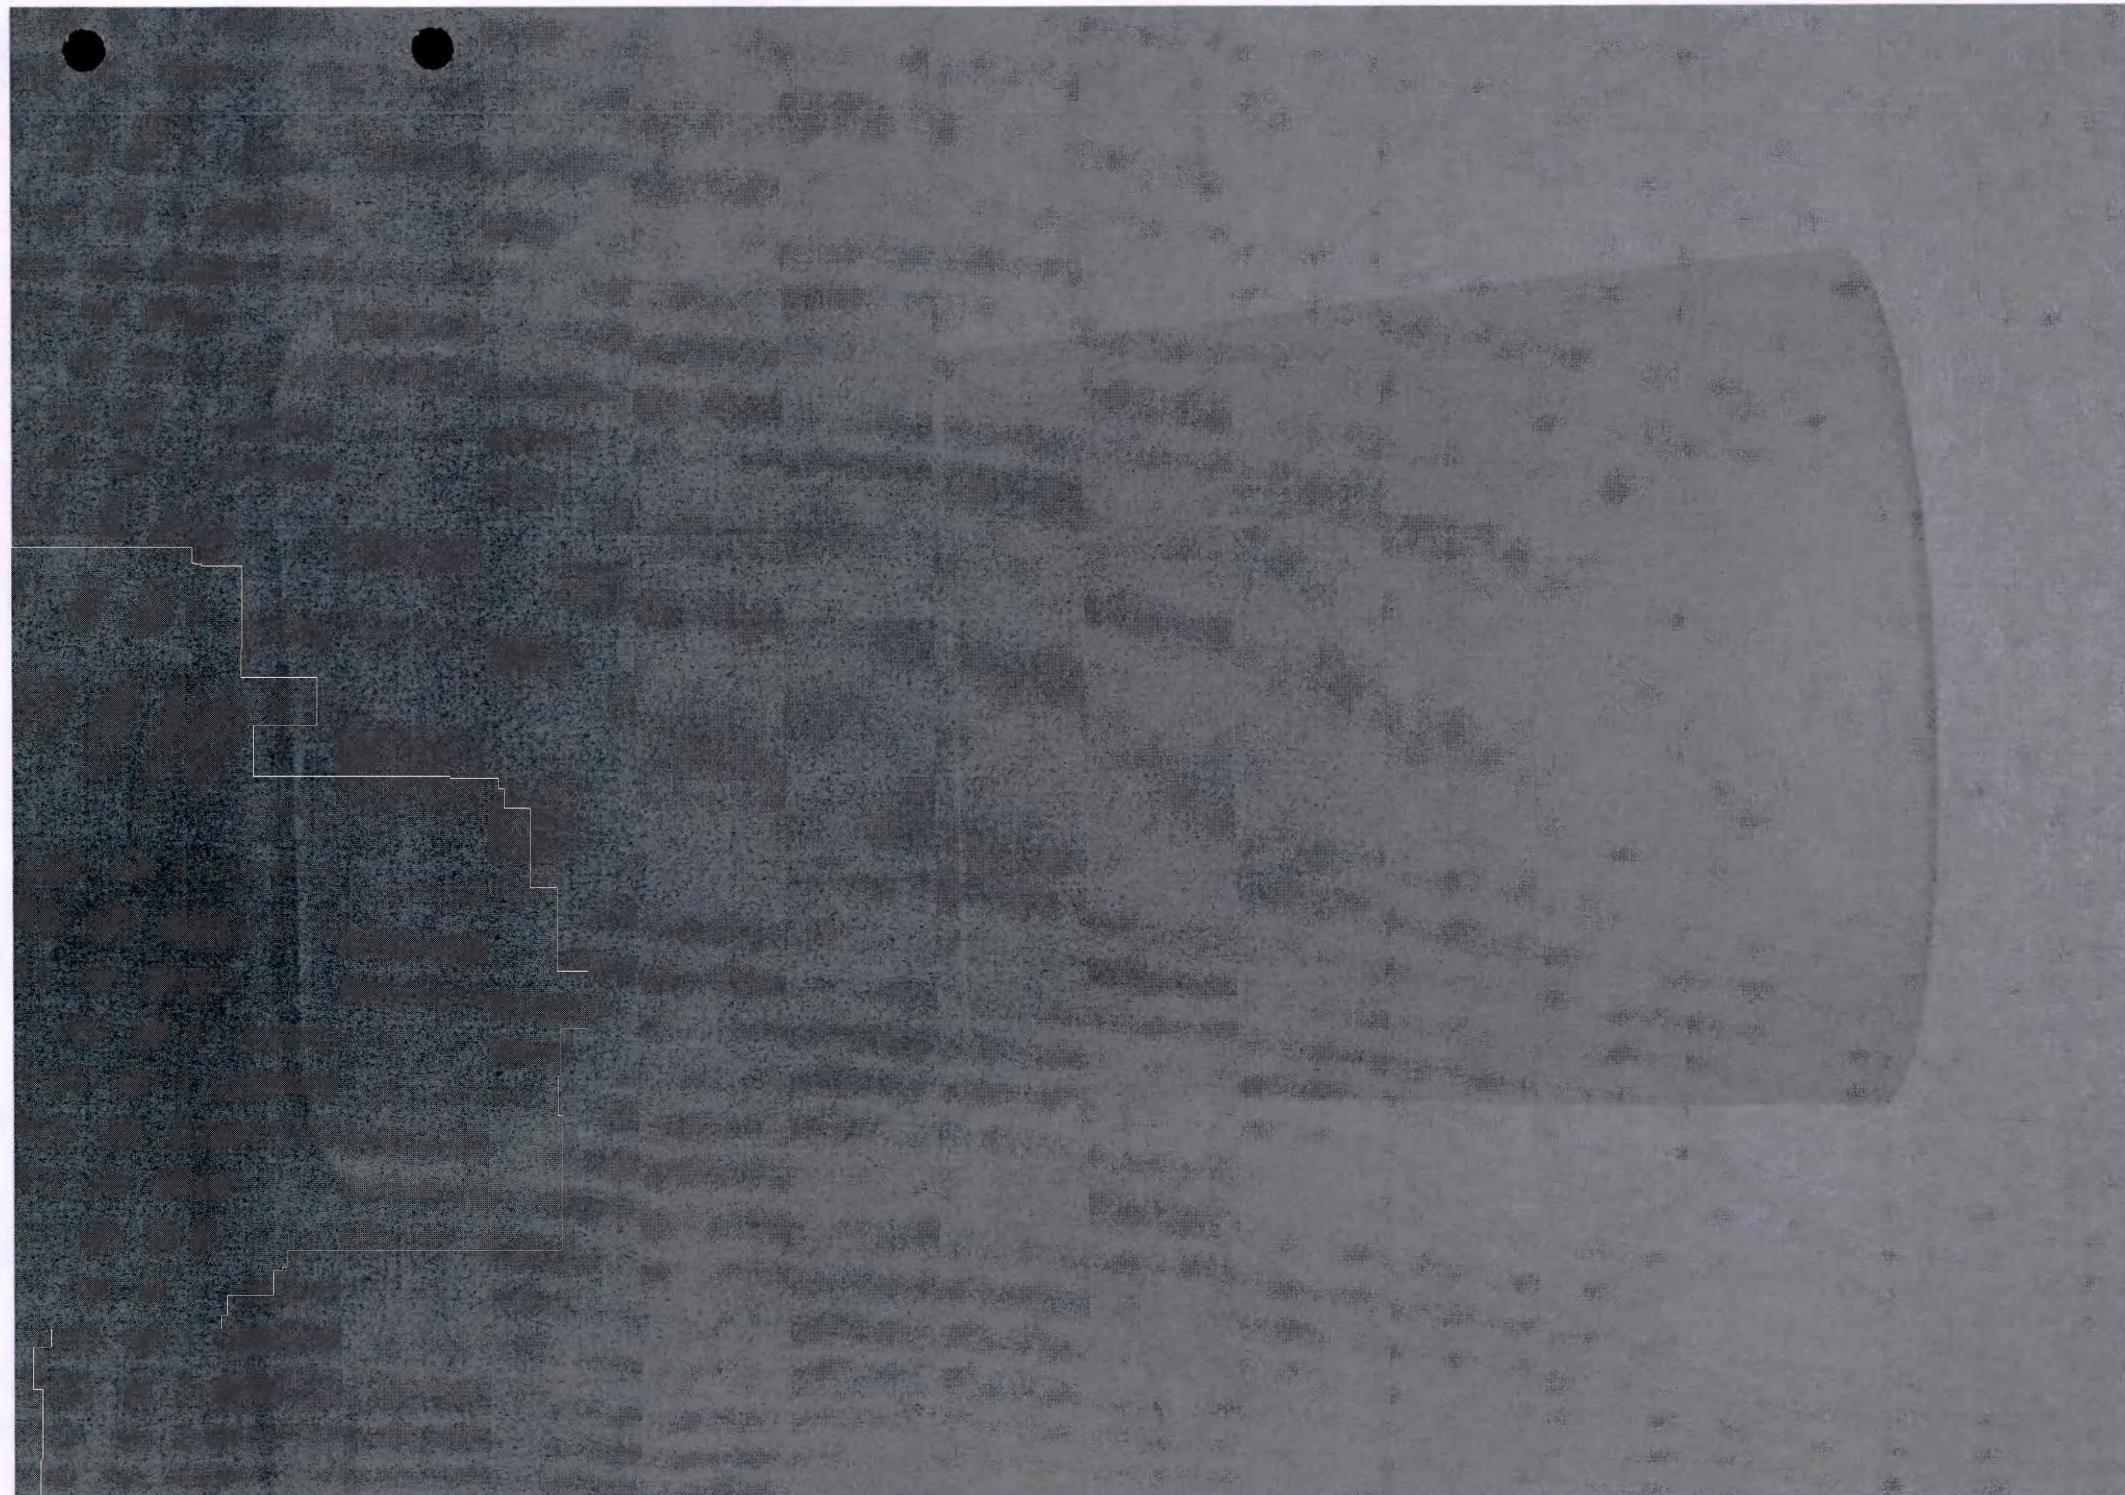




Рис. 14 – Элемент питания тип АА (2 шт.)

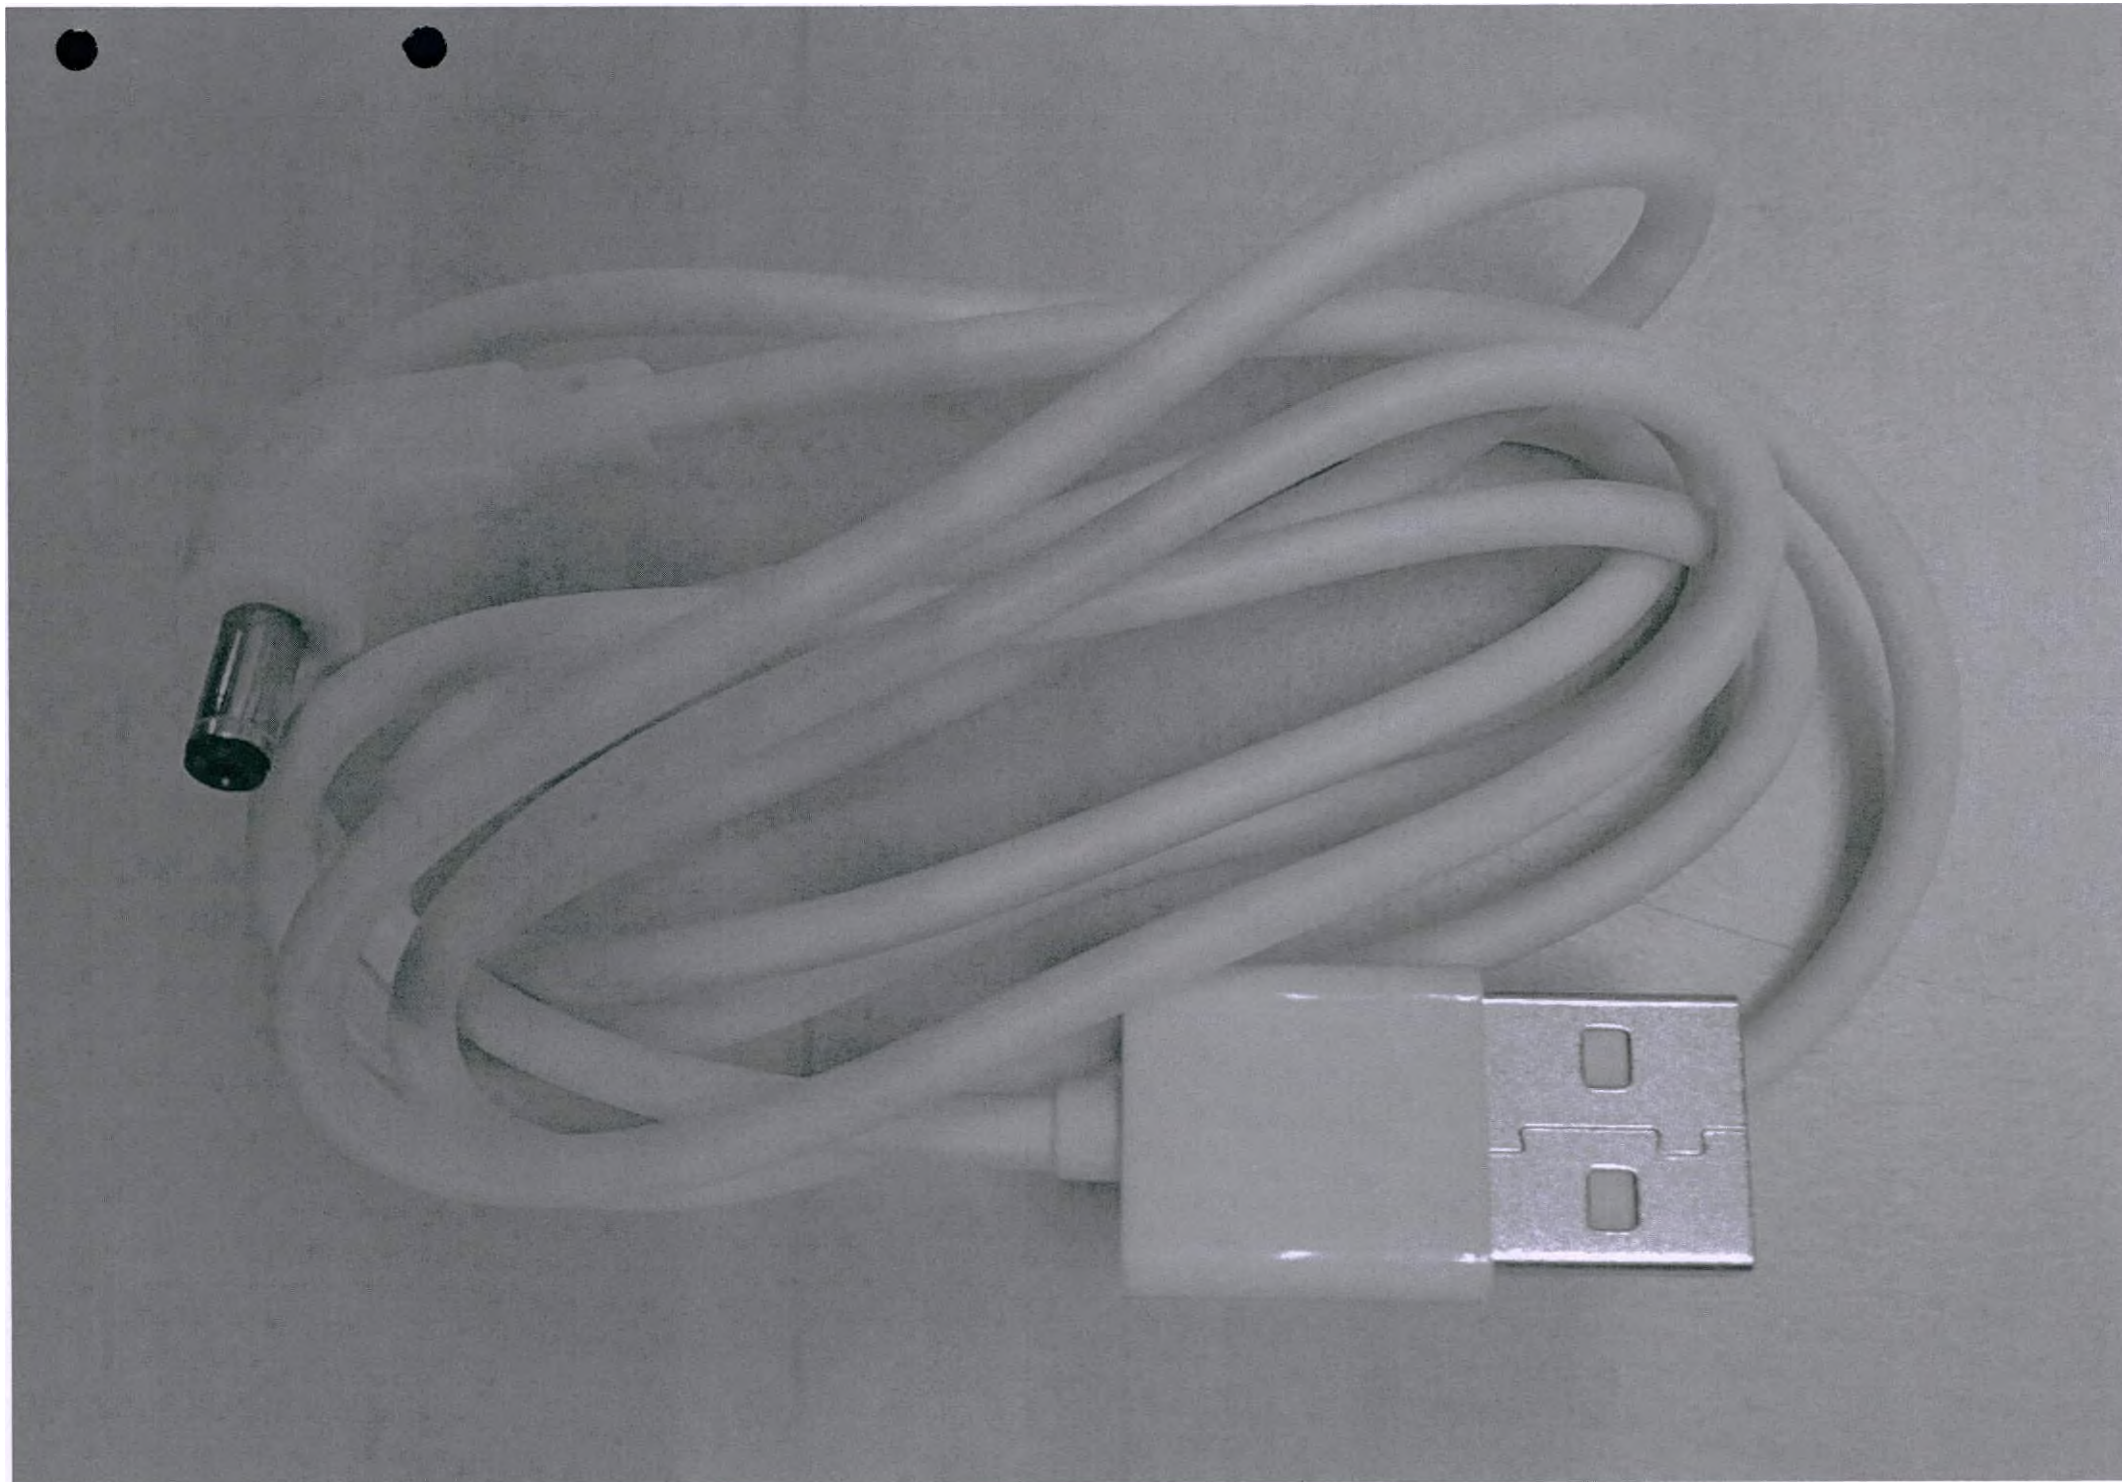


Рис. 15 – Кабель питания USB



Рис. 16 – Сумка

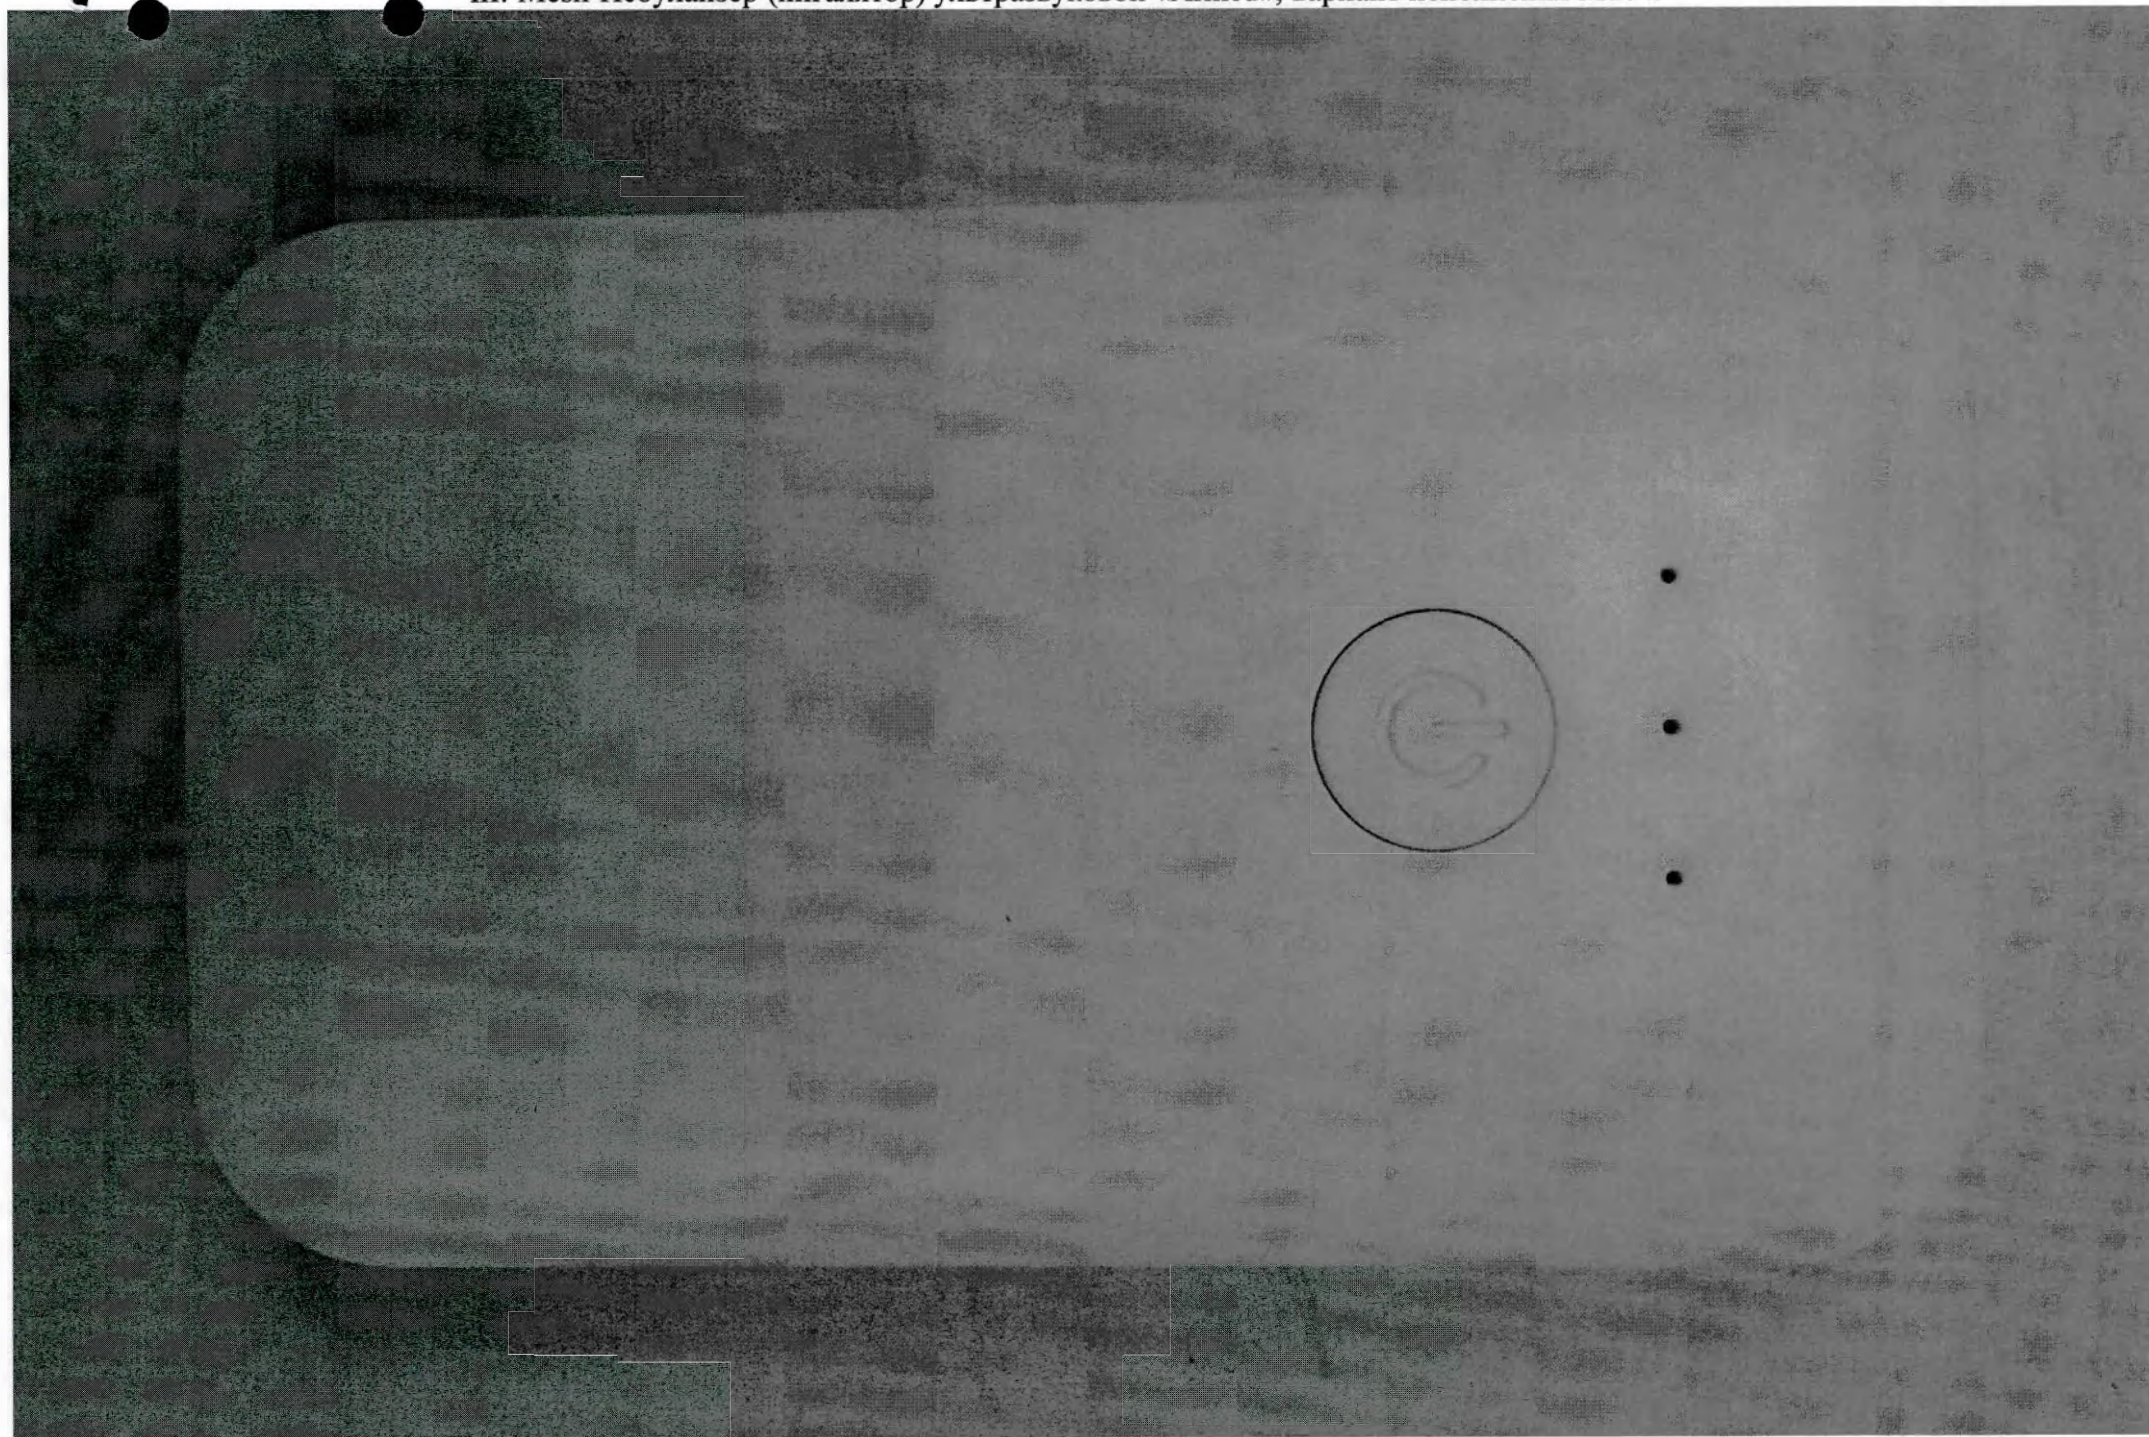
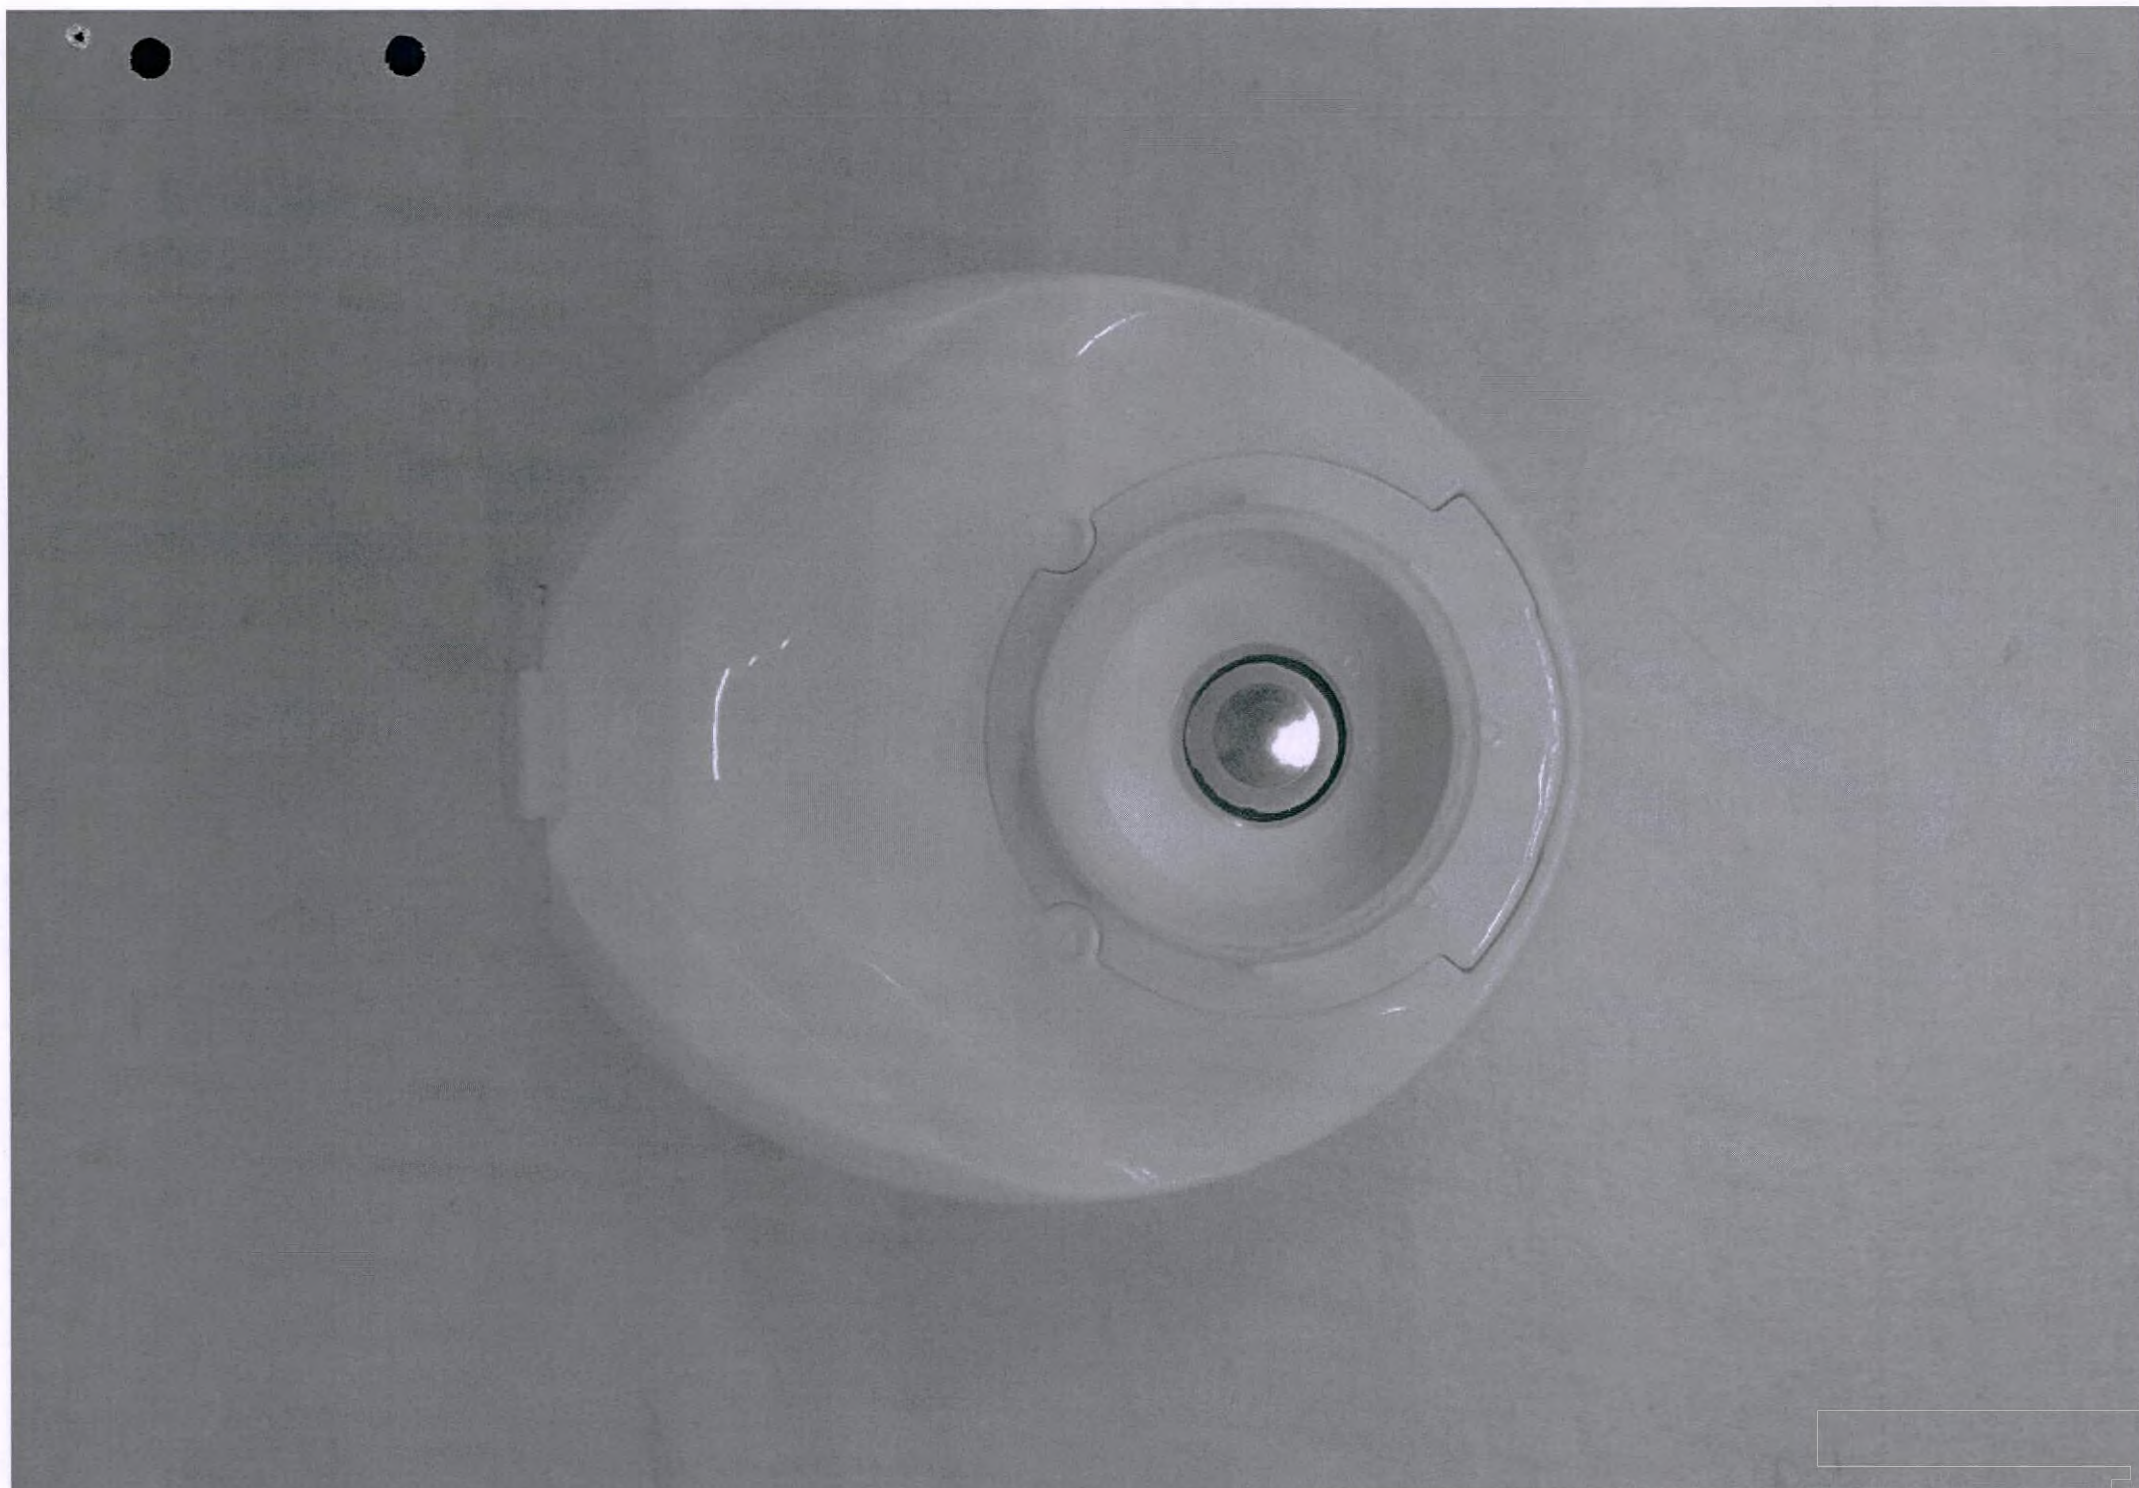
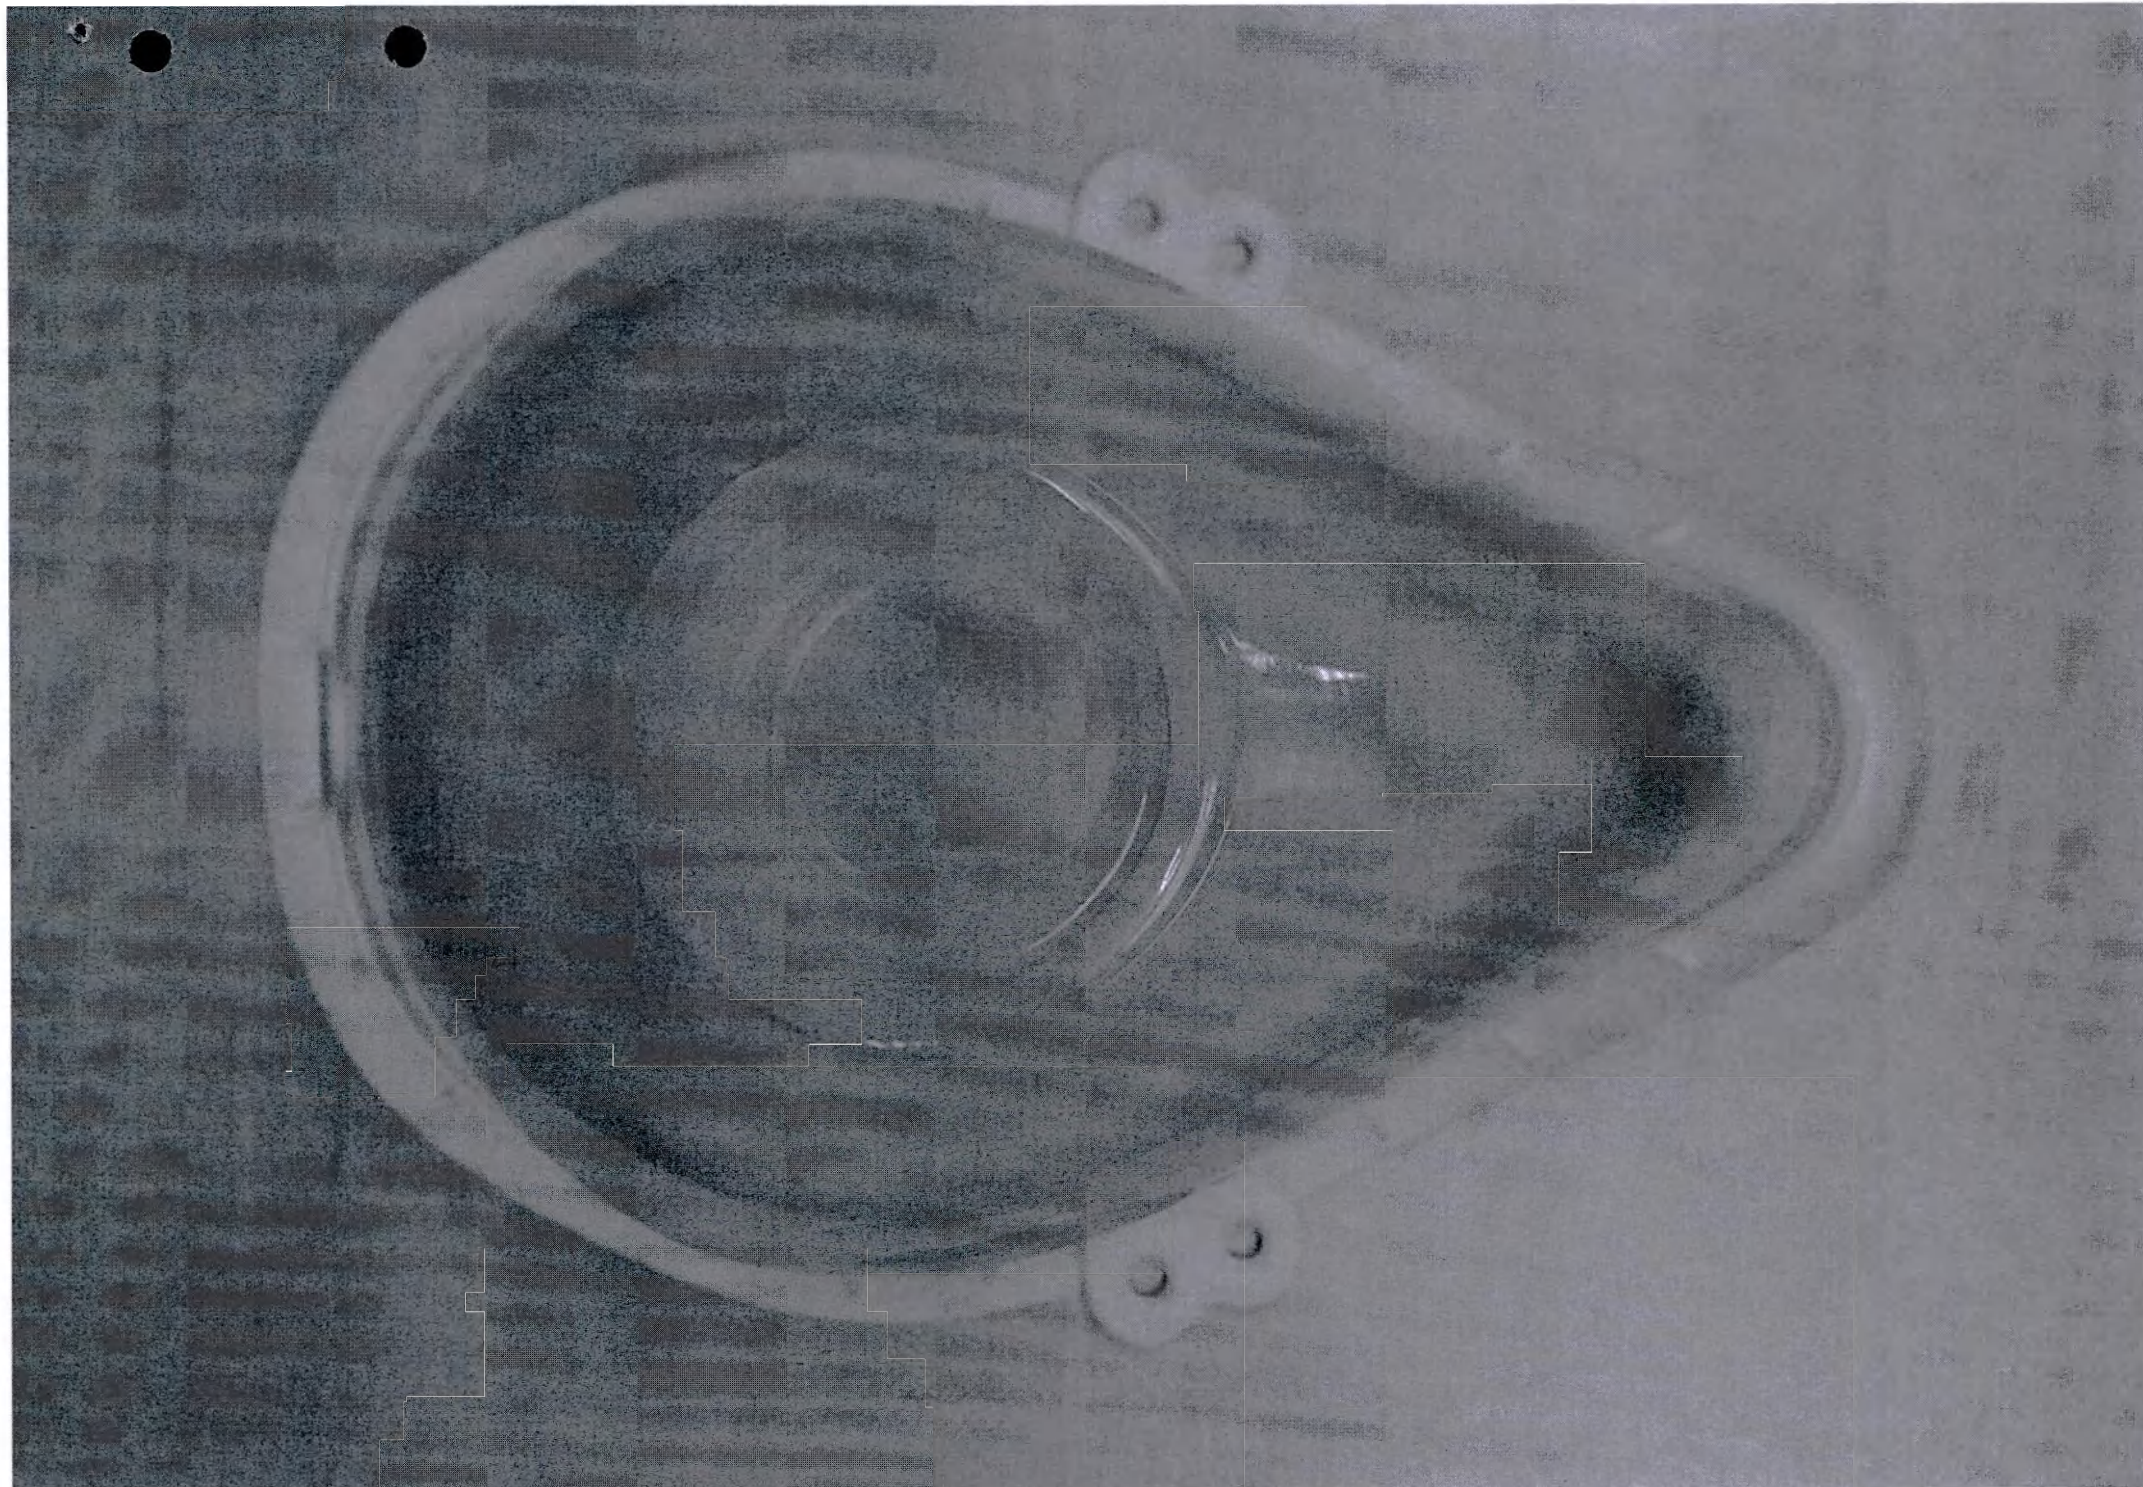
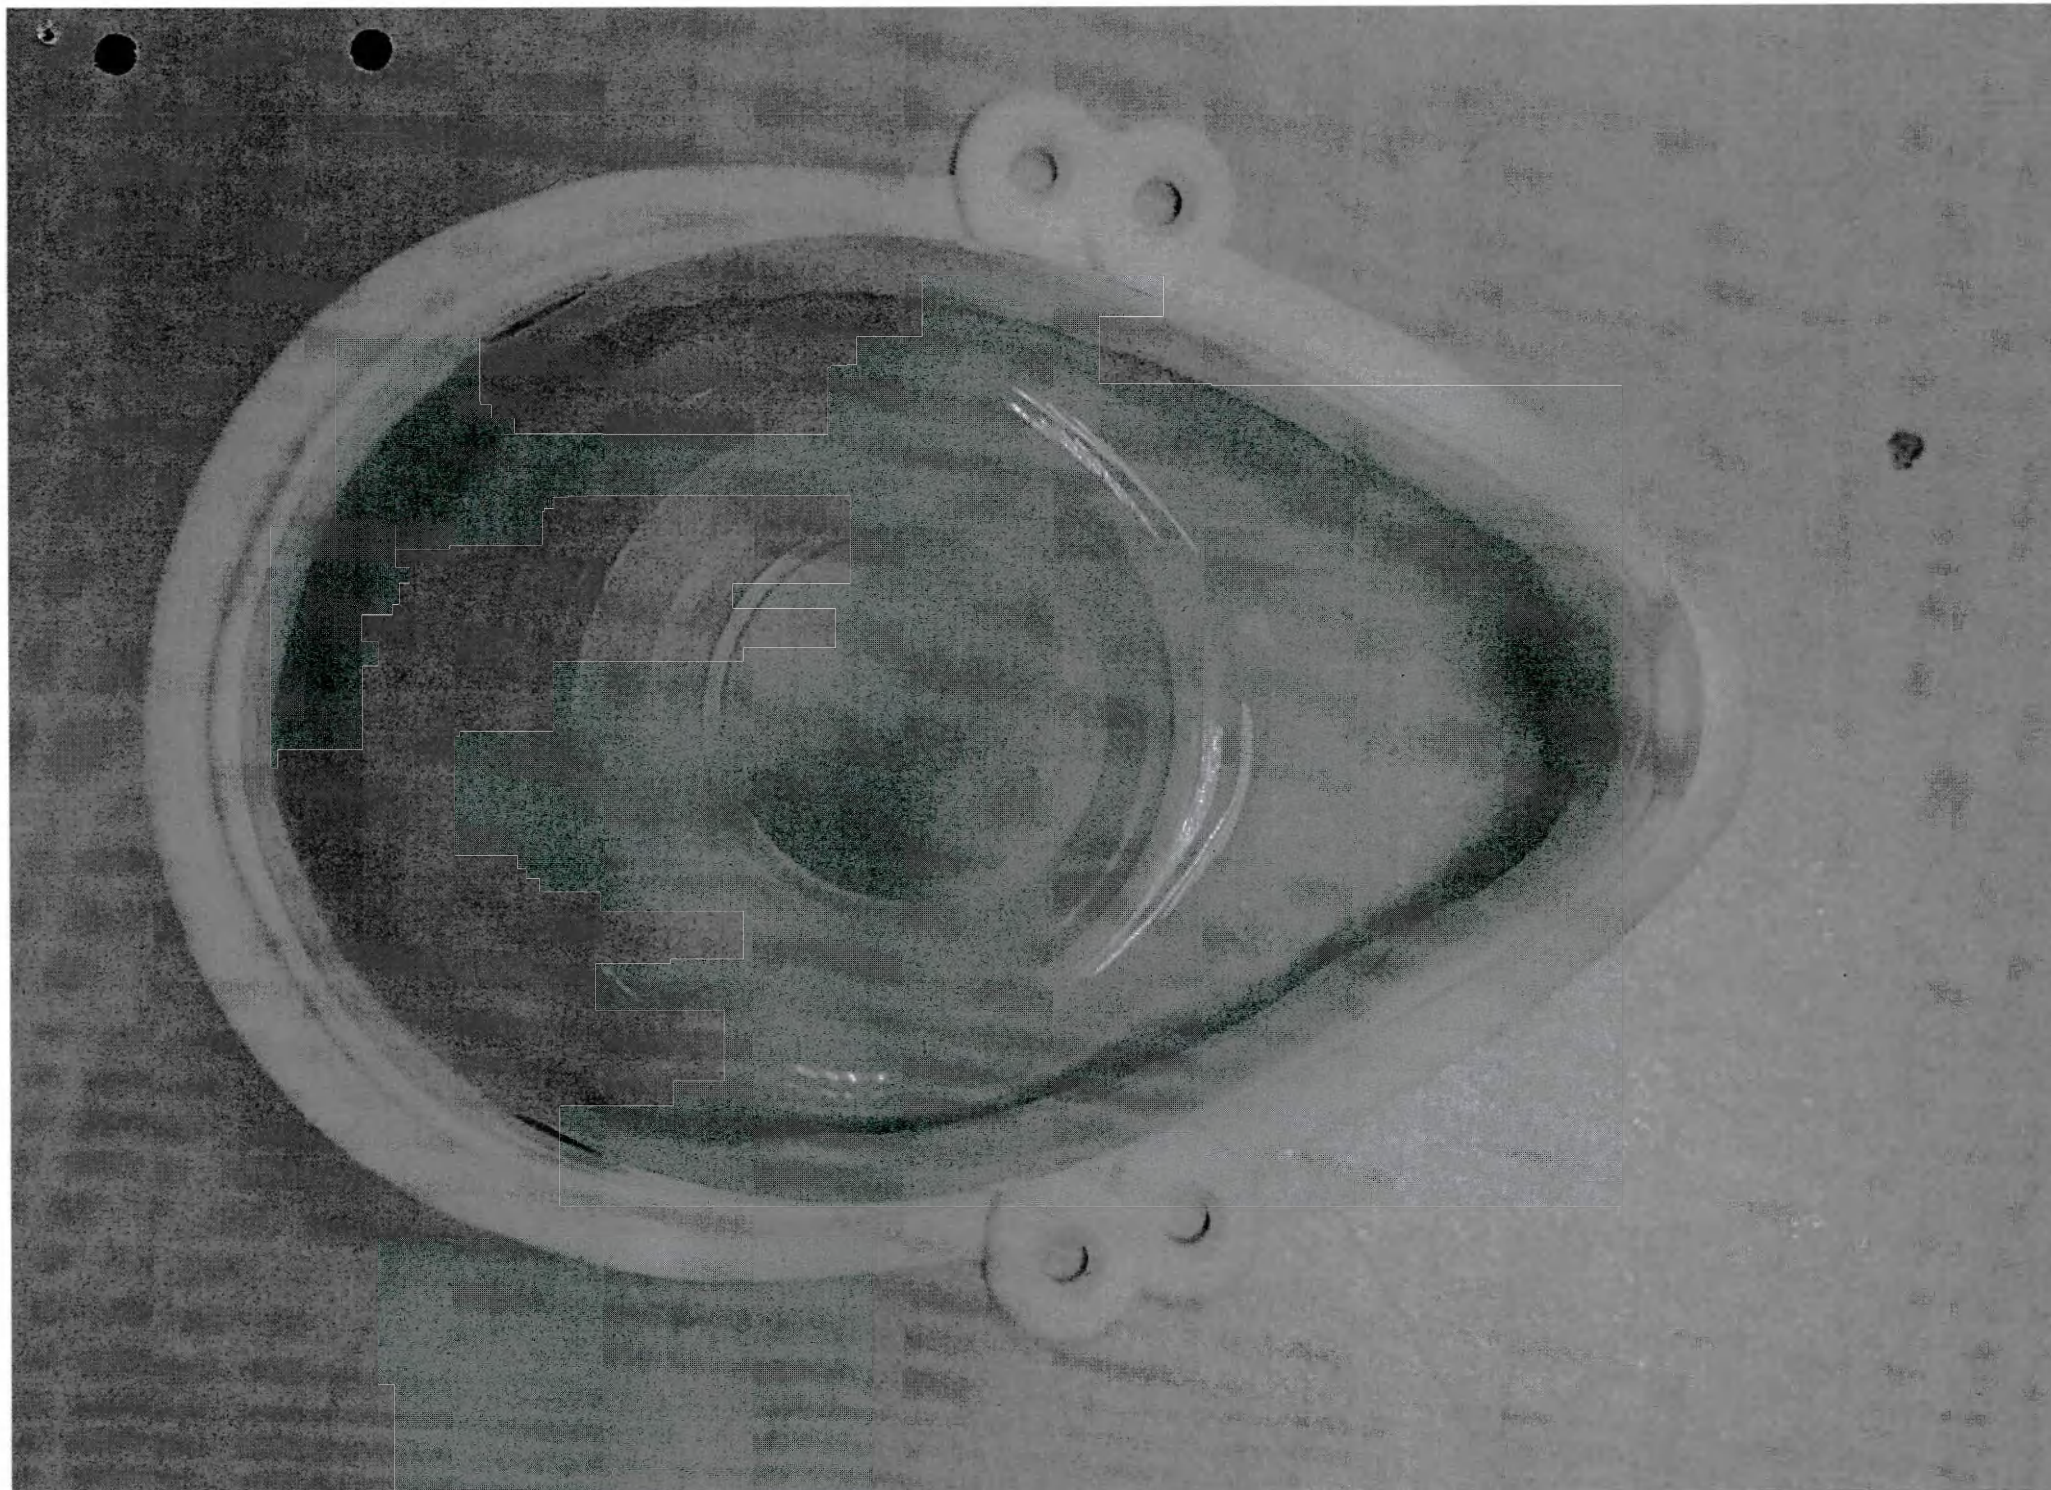


Рис. 17 – Блок питания







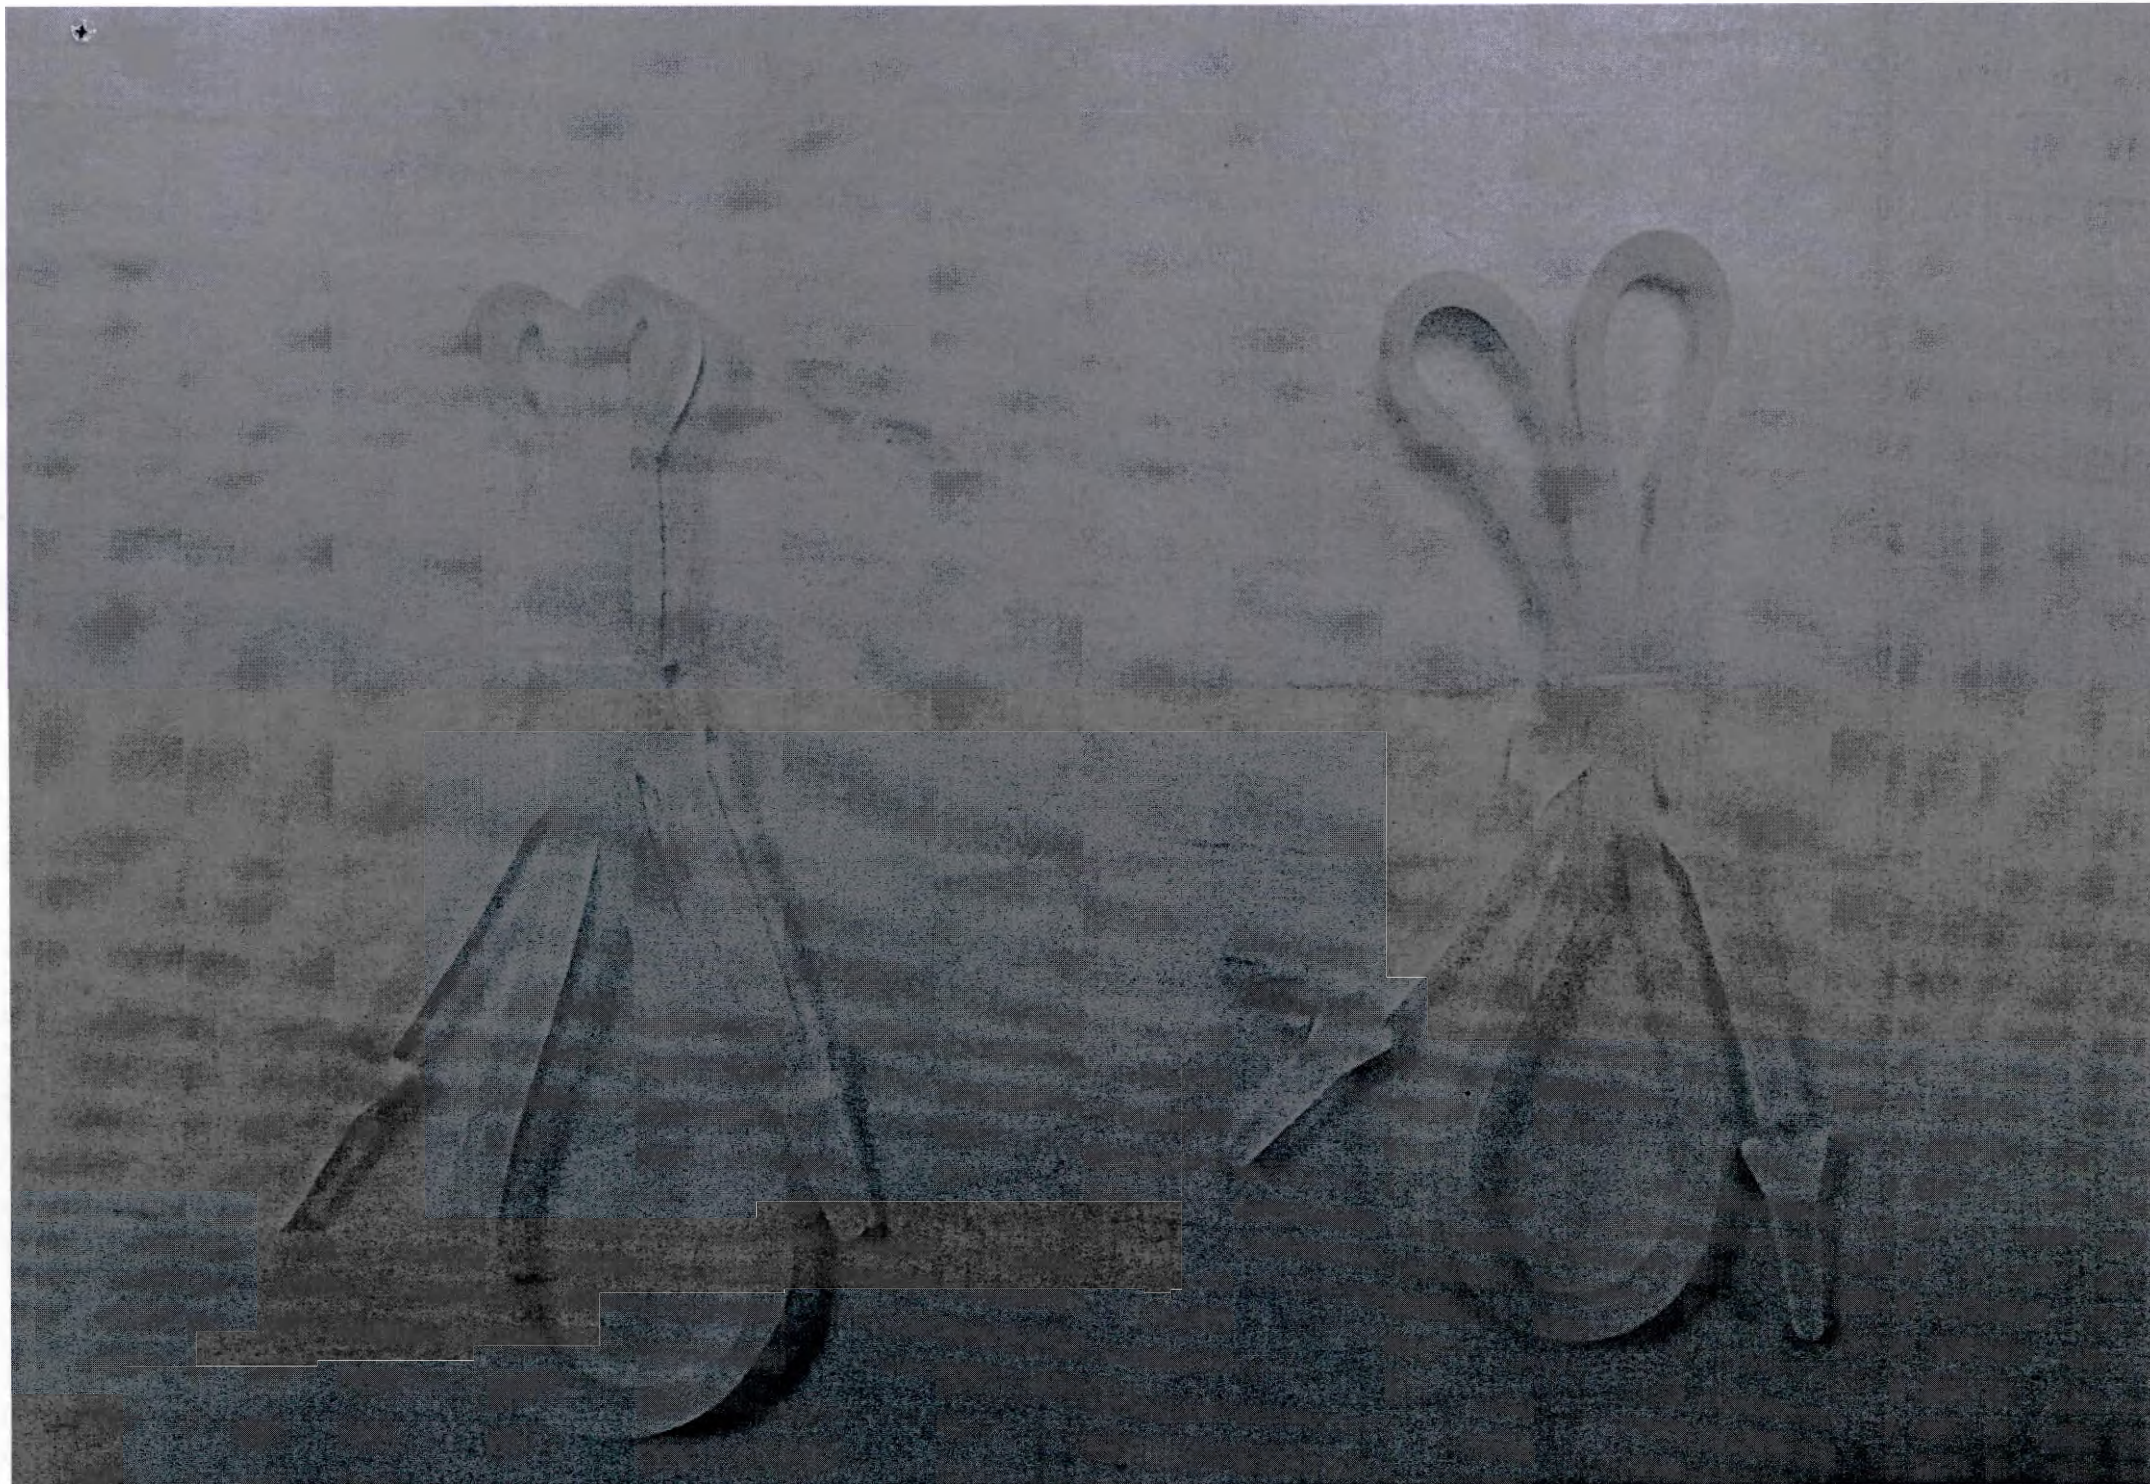


Рис. 21 – Держатель маски силиконовый (2 шт.)



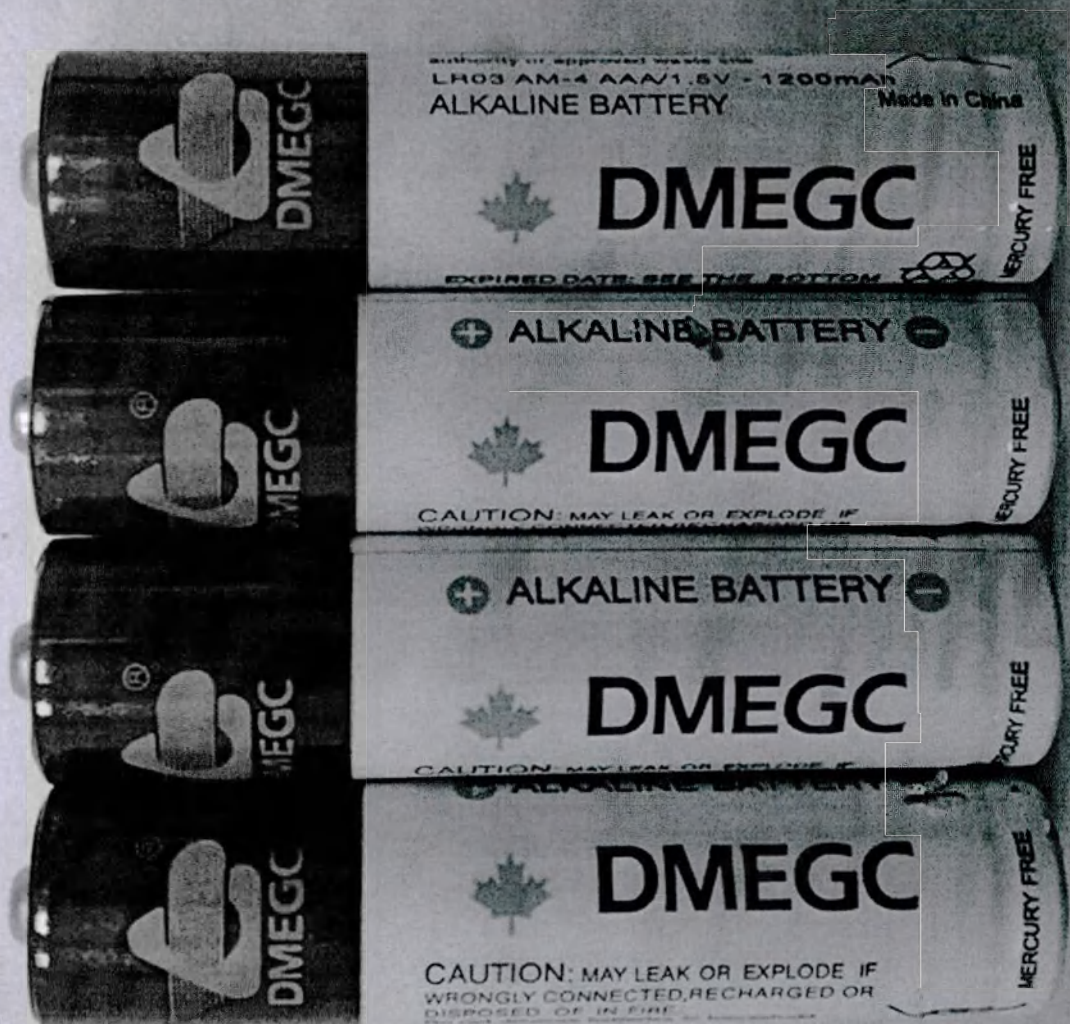


Рис. 23 – Элемент питания, тип AAA (4 шт.)

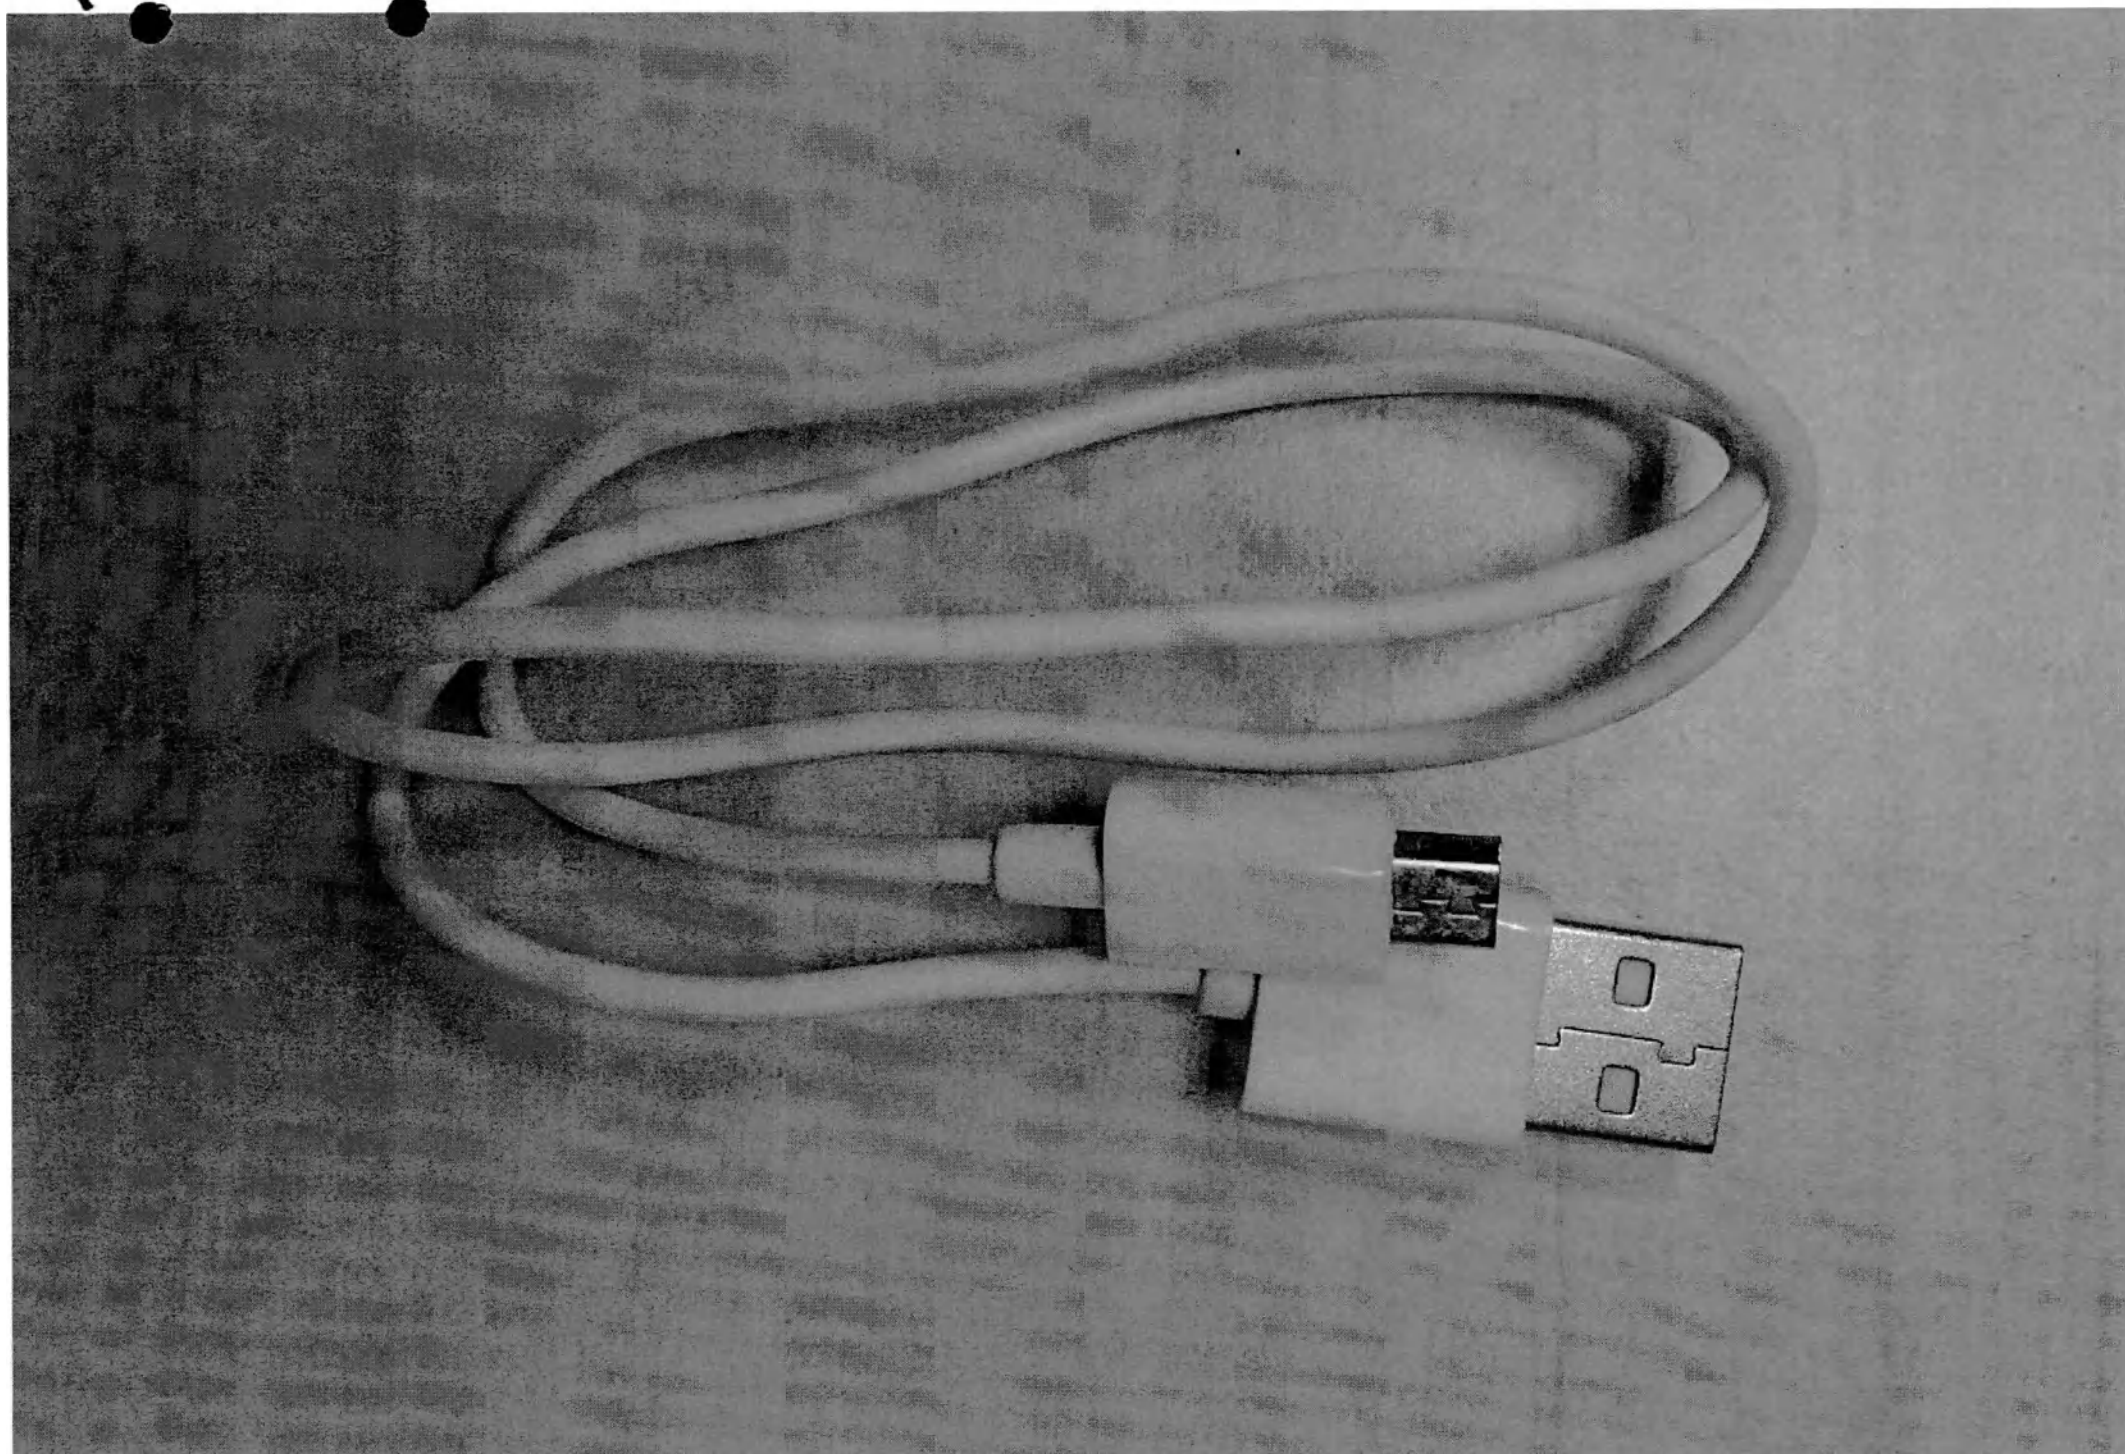


Рис. 24 – Кабель питания USB

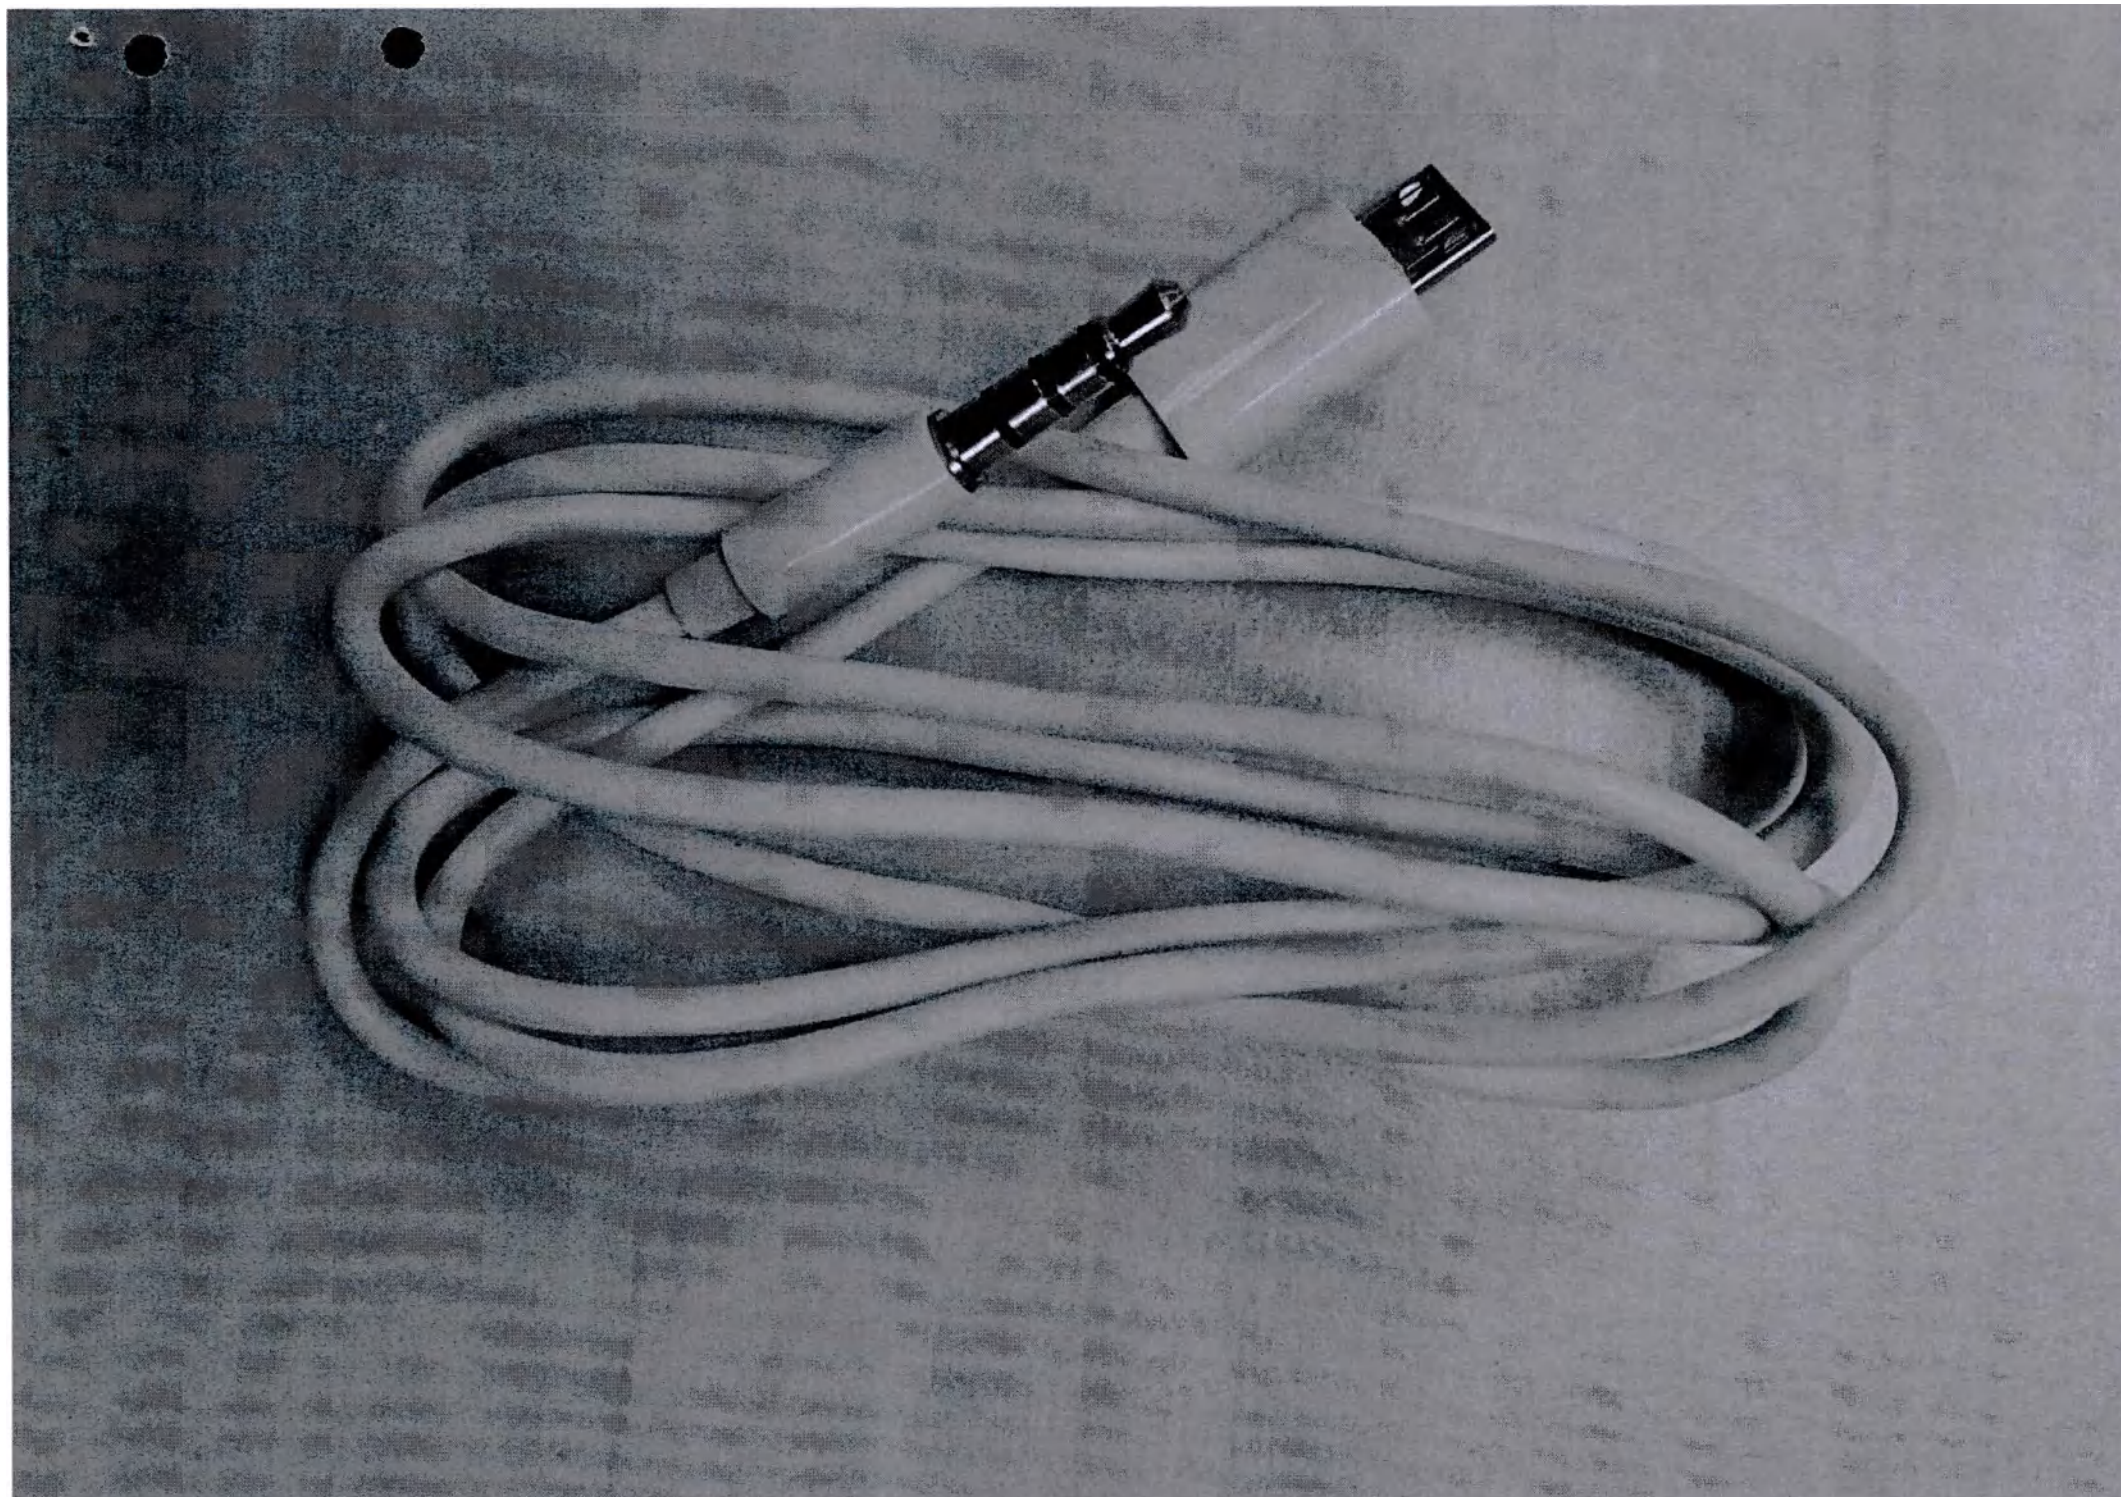




Рис. 26 – Сумка

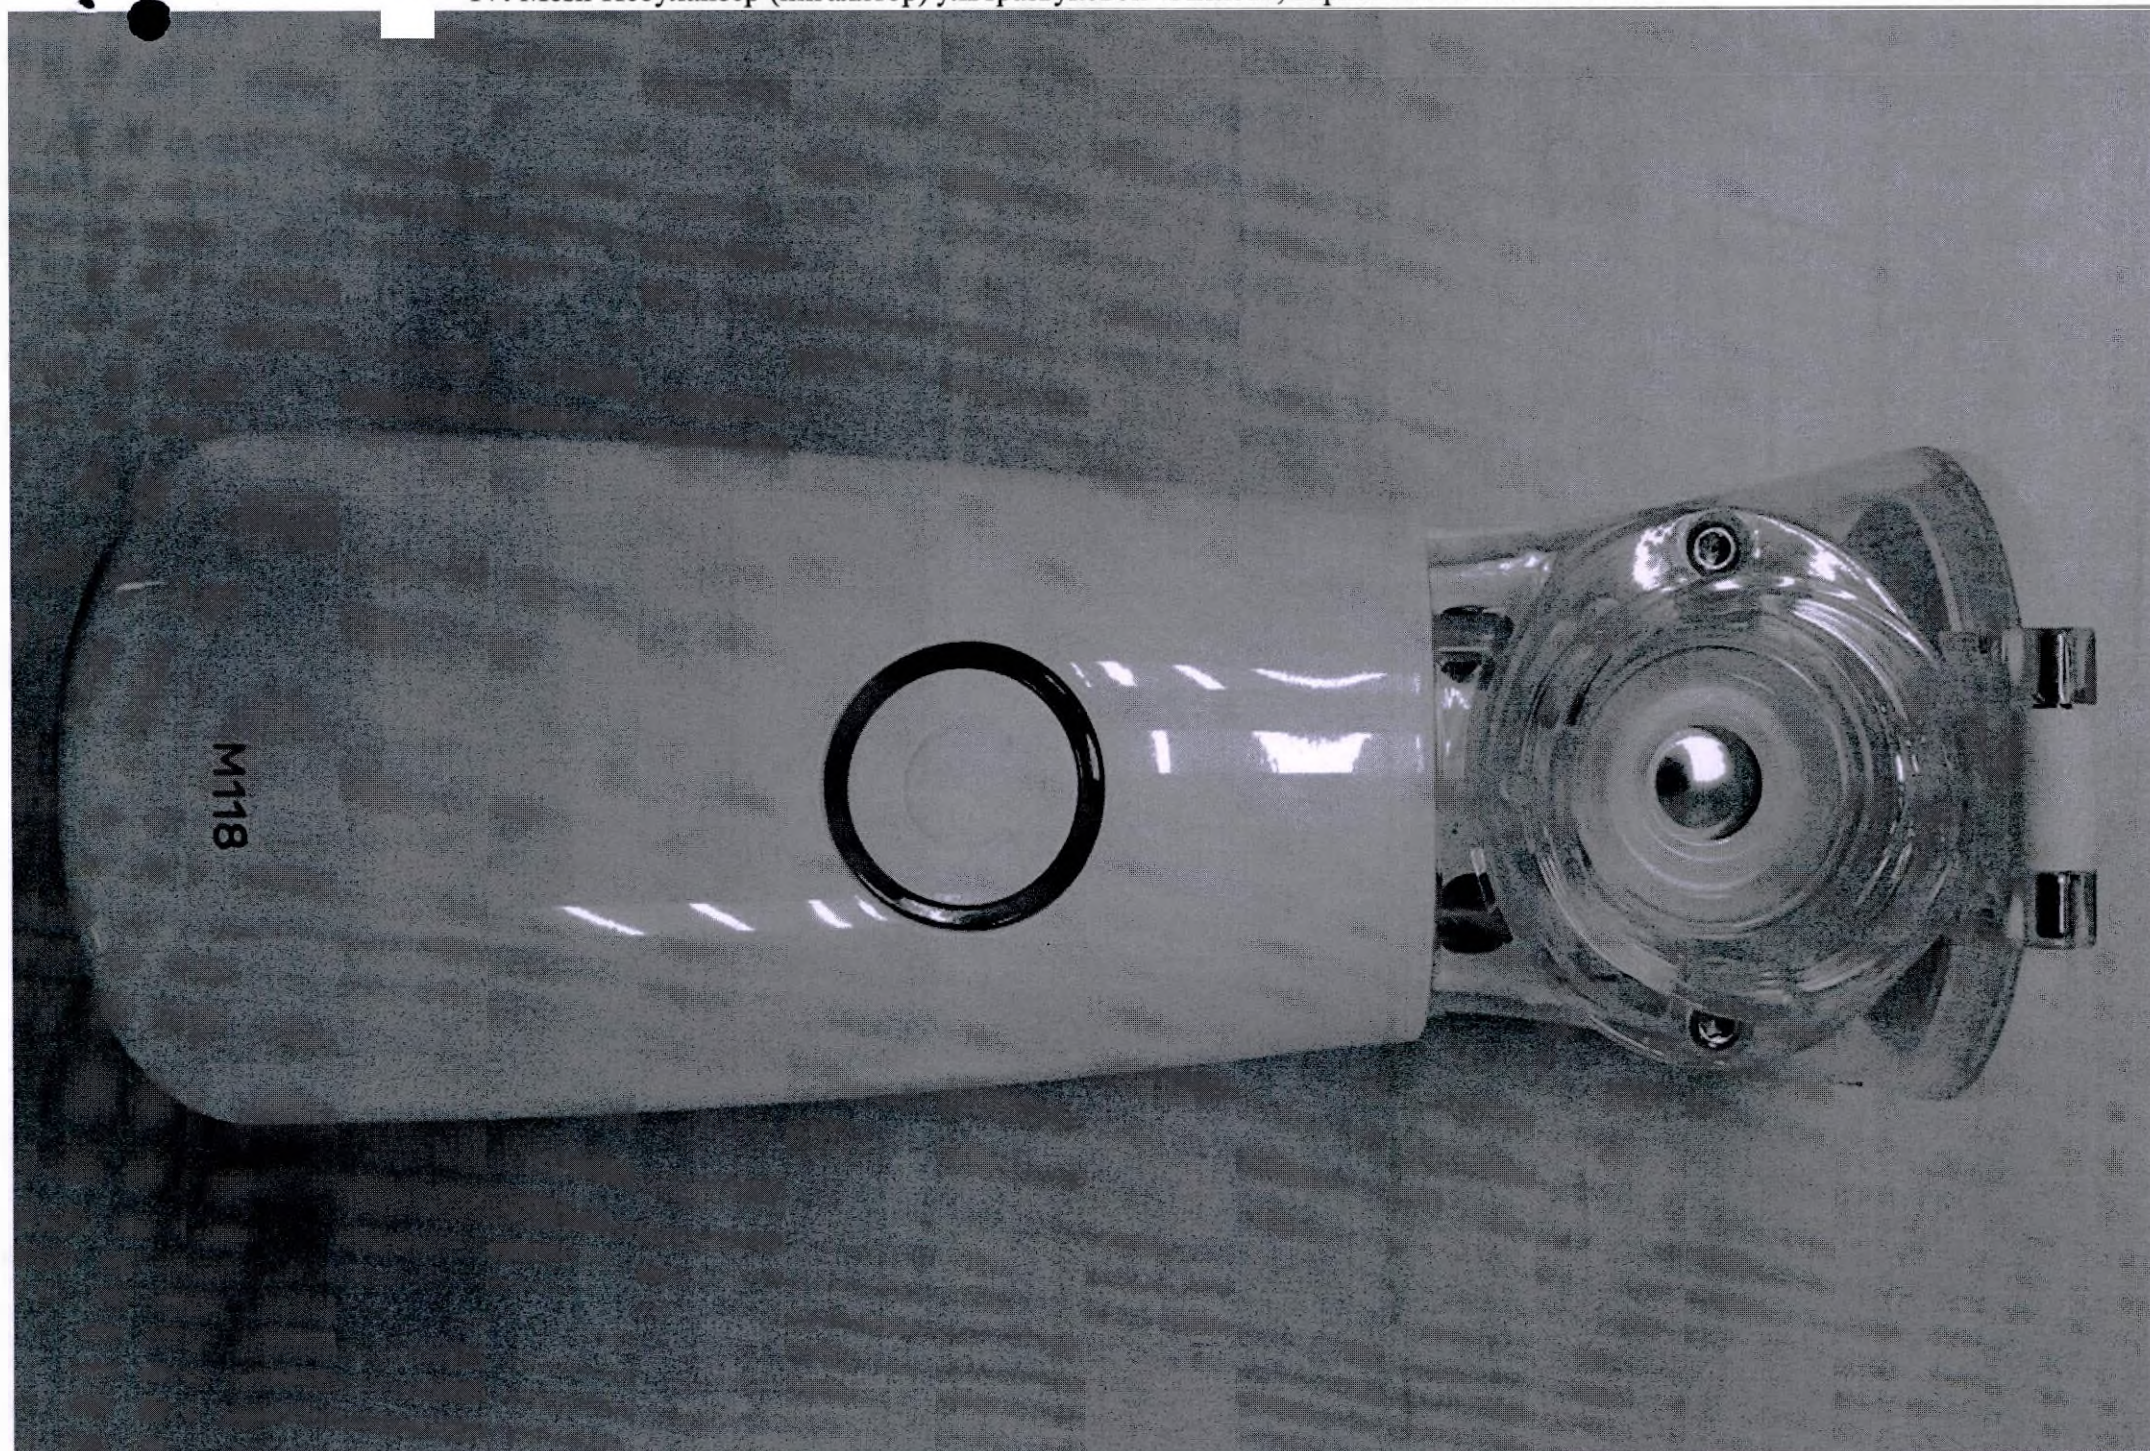
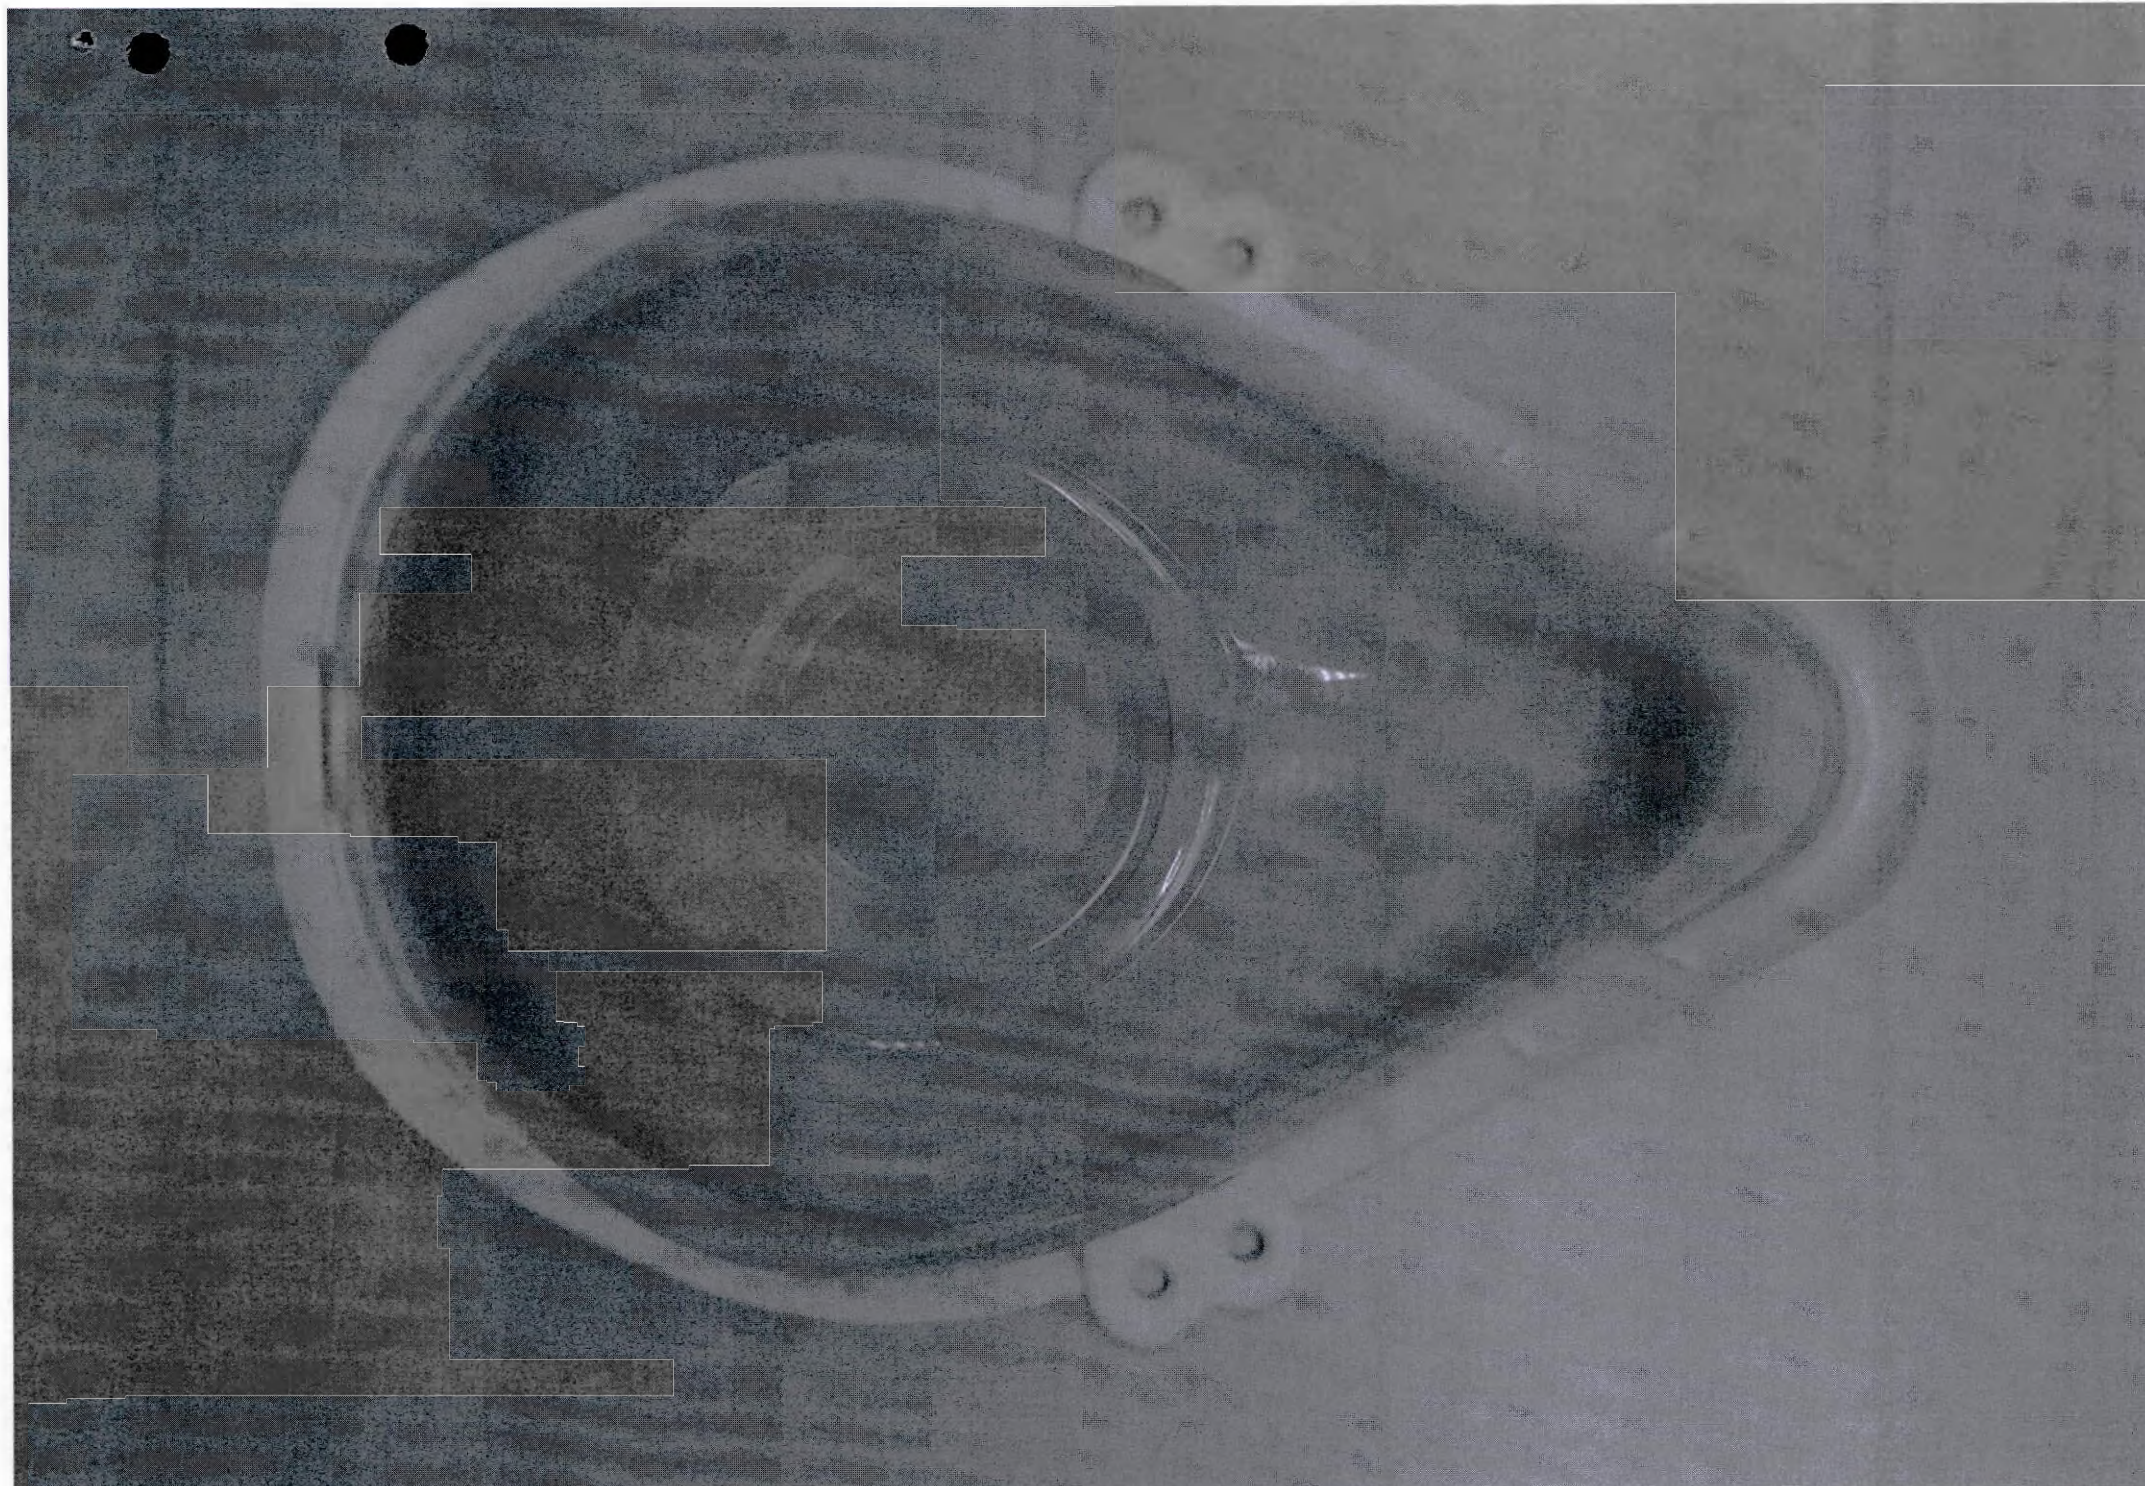
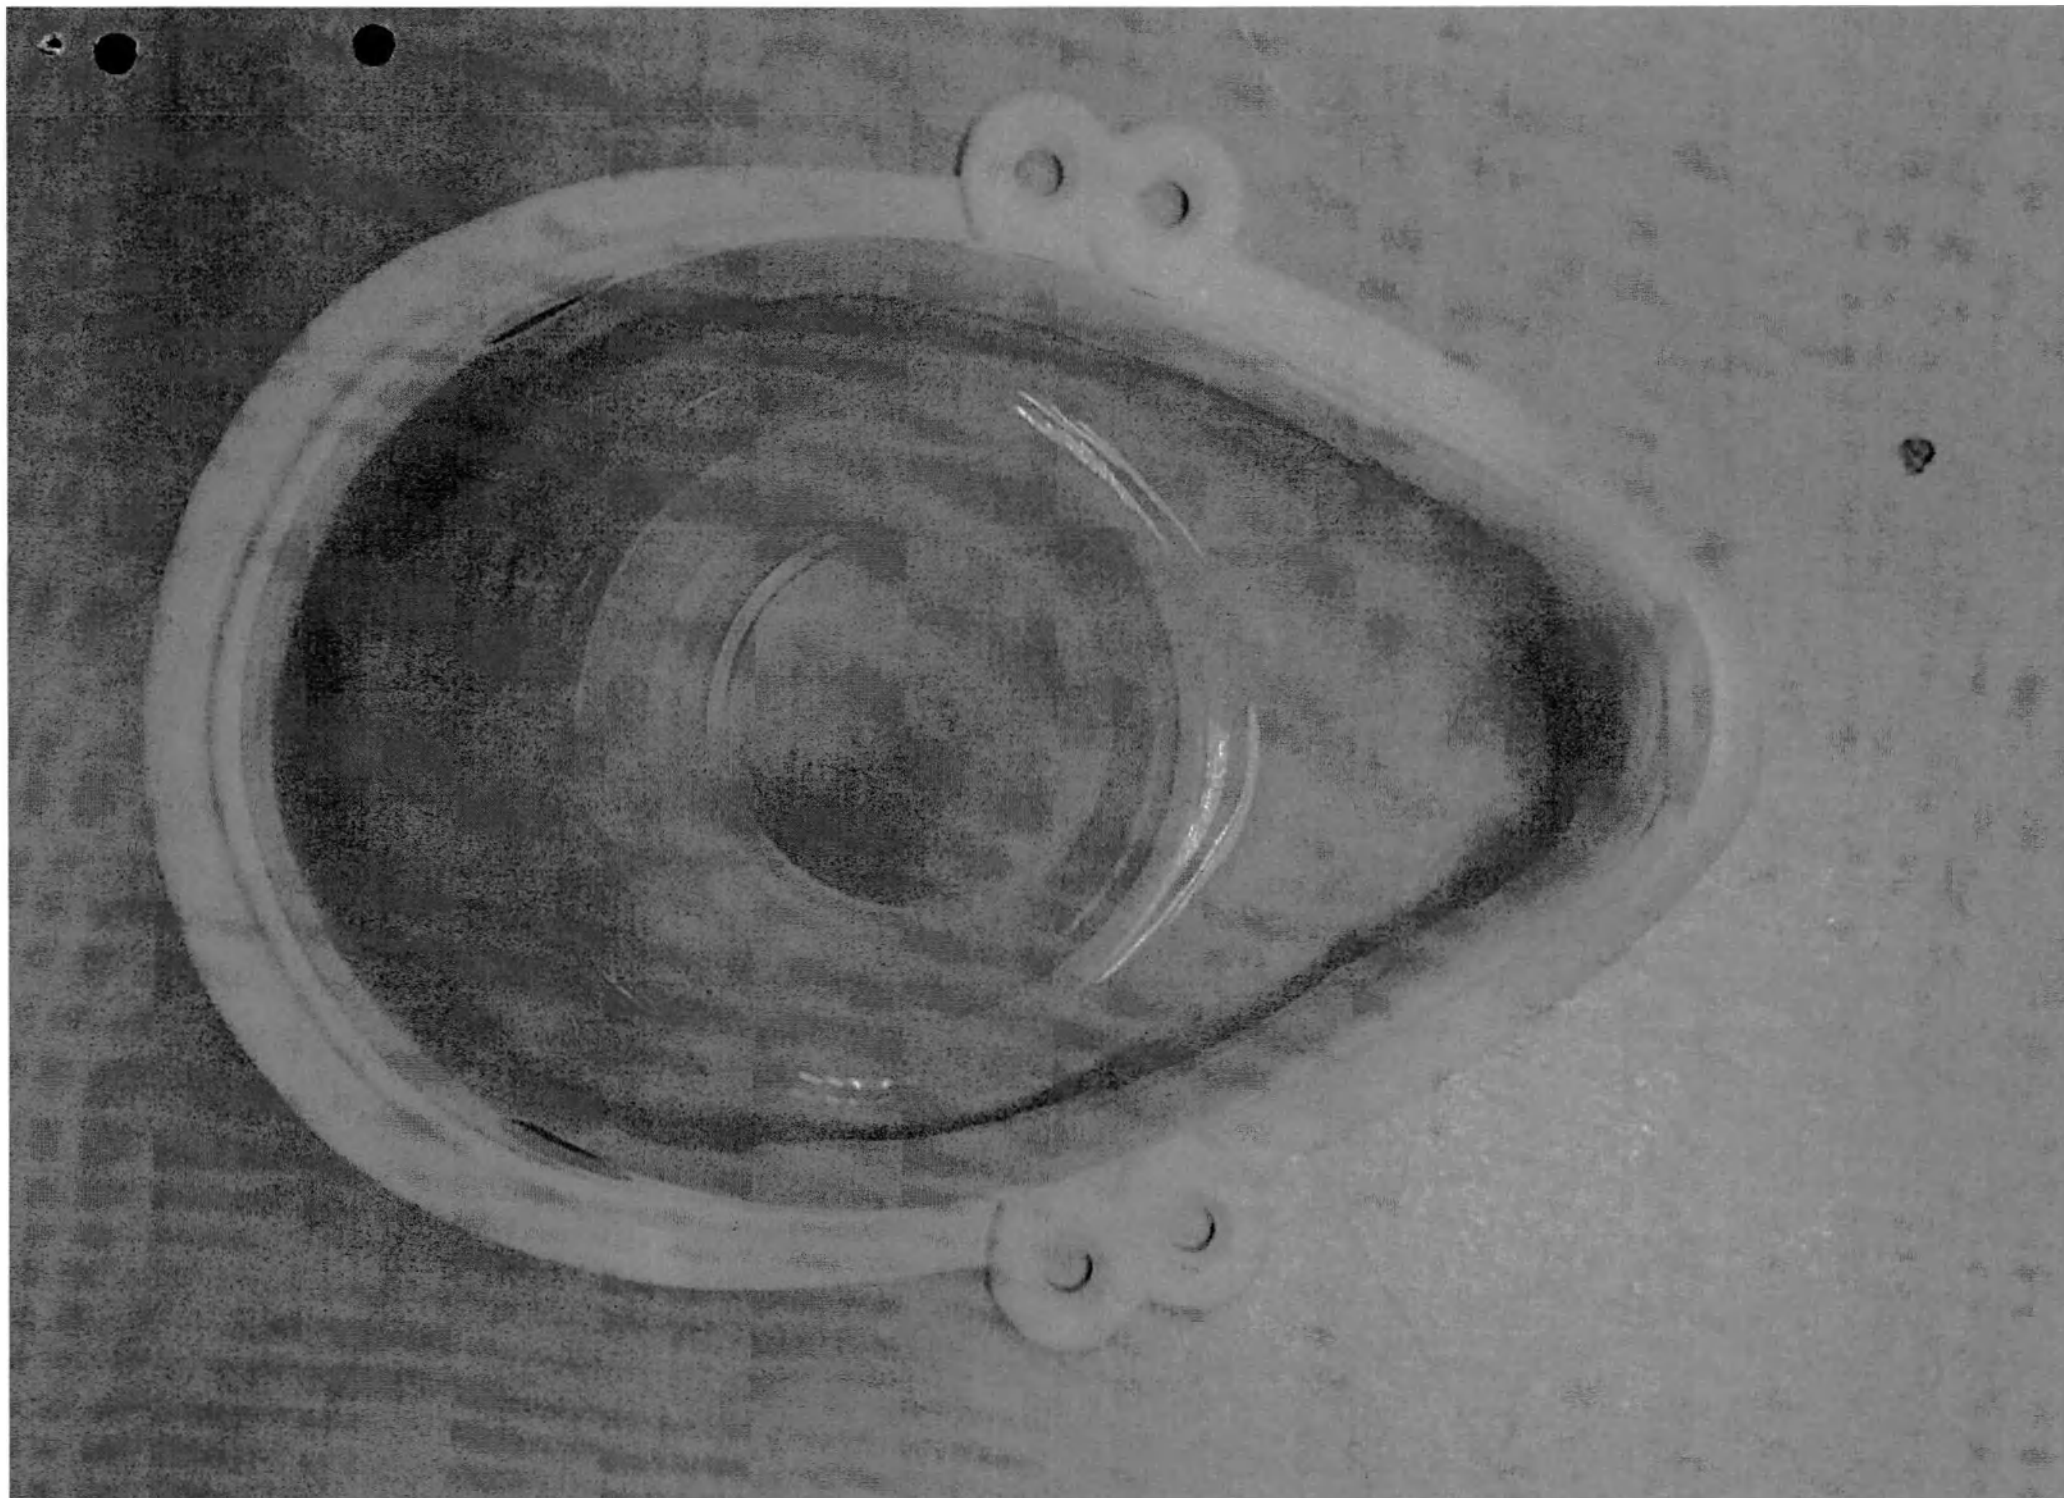


Рис. 27 – Базовый блок







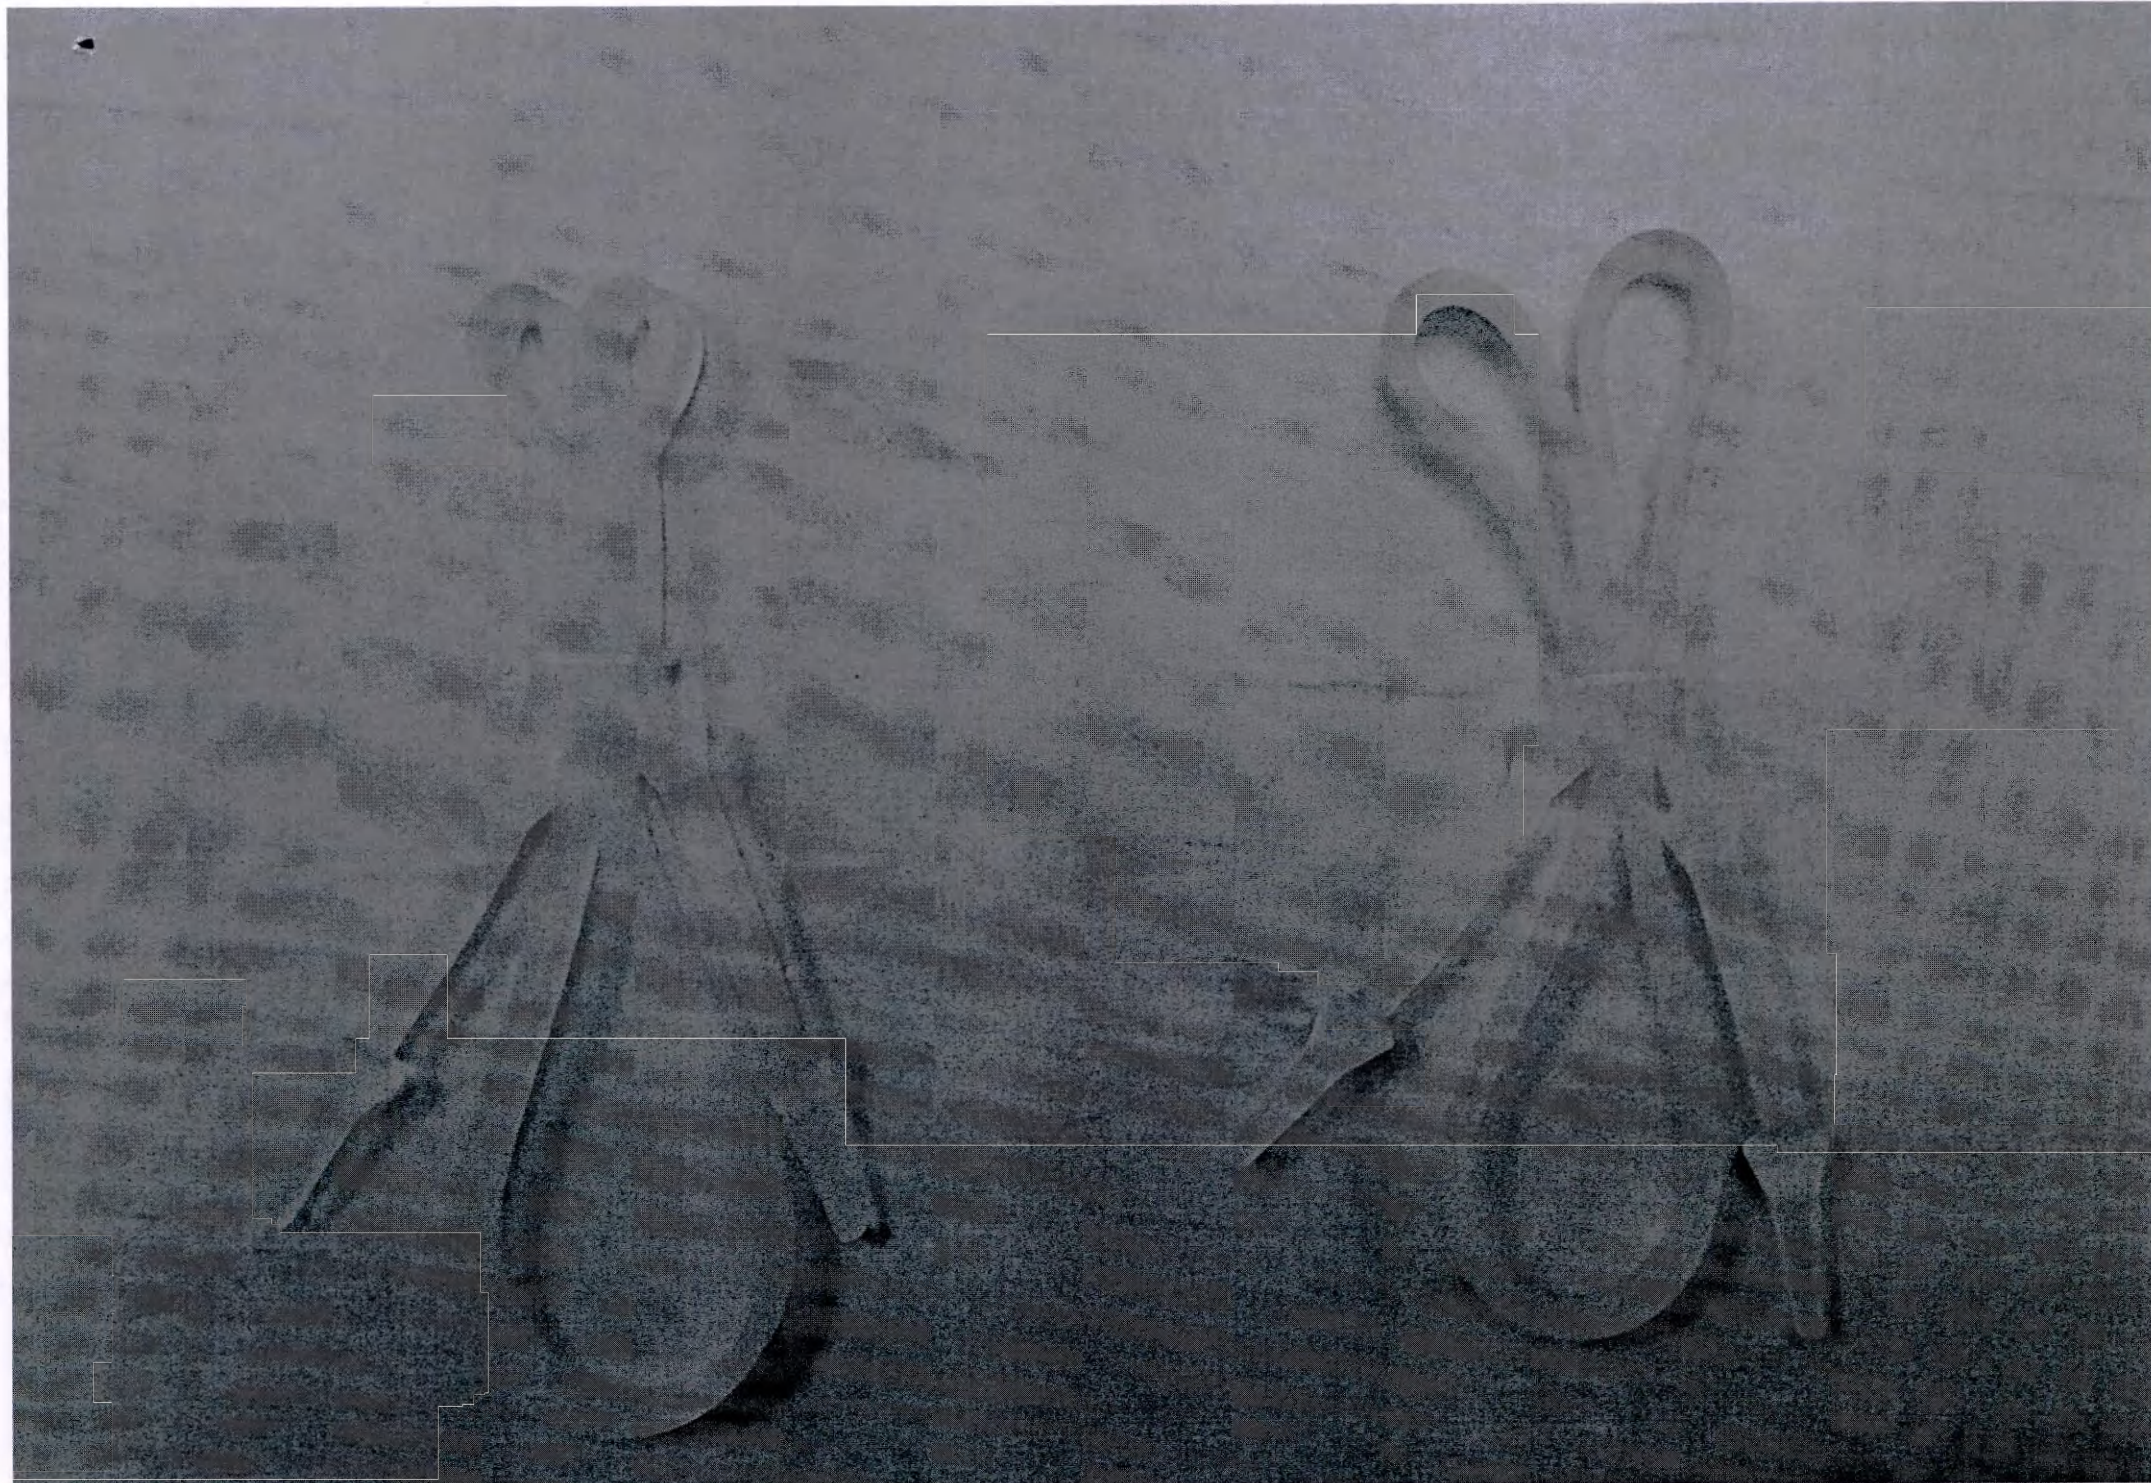


Рис. 30 – Держатель маски силиконовый (2 шт.)



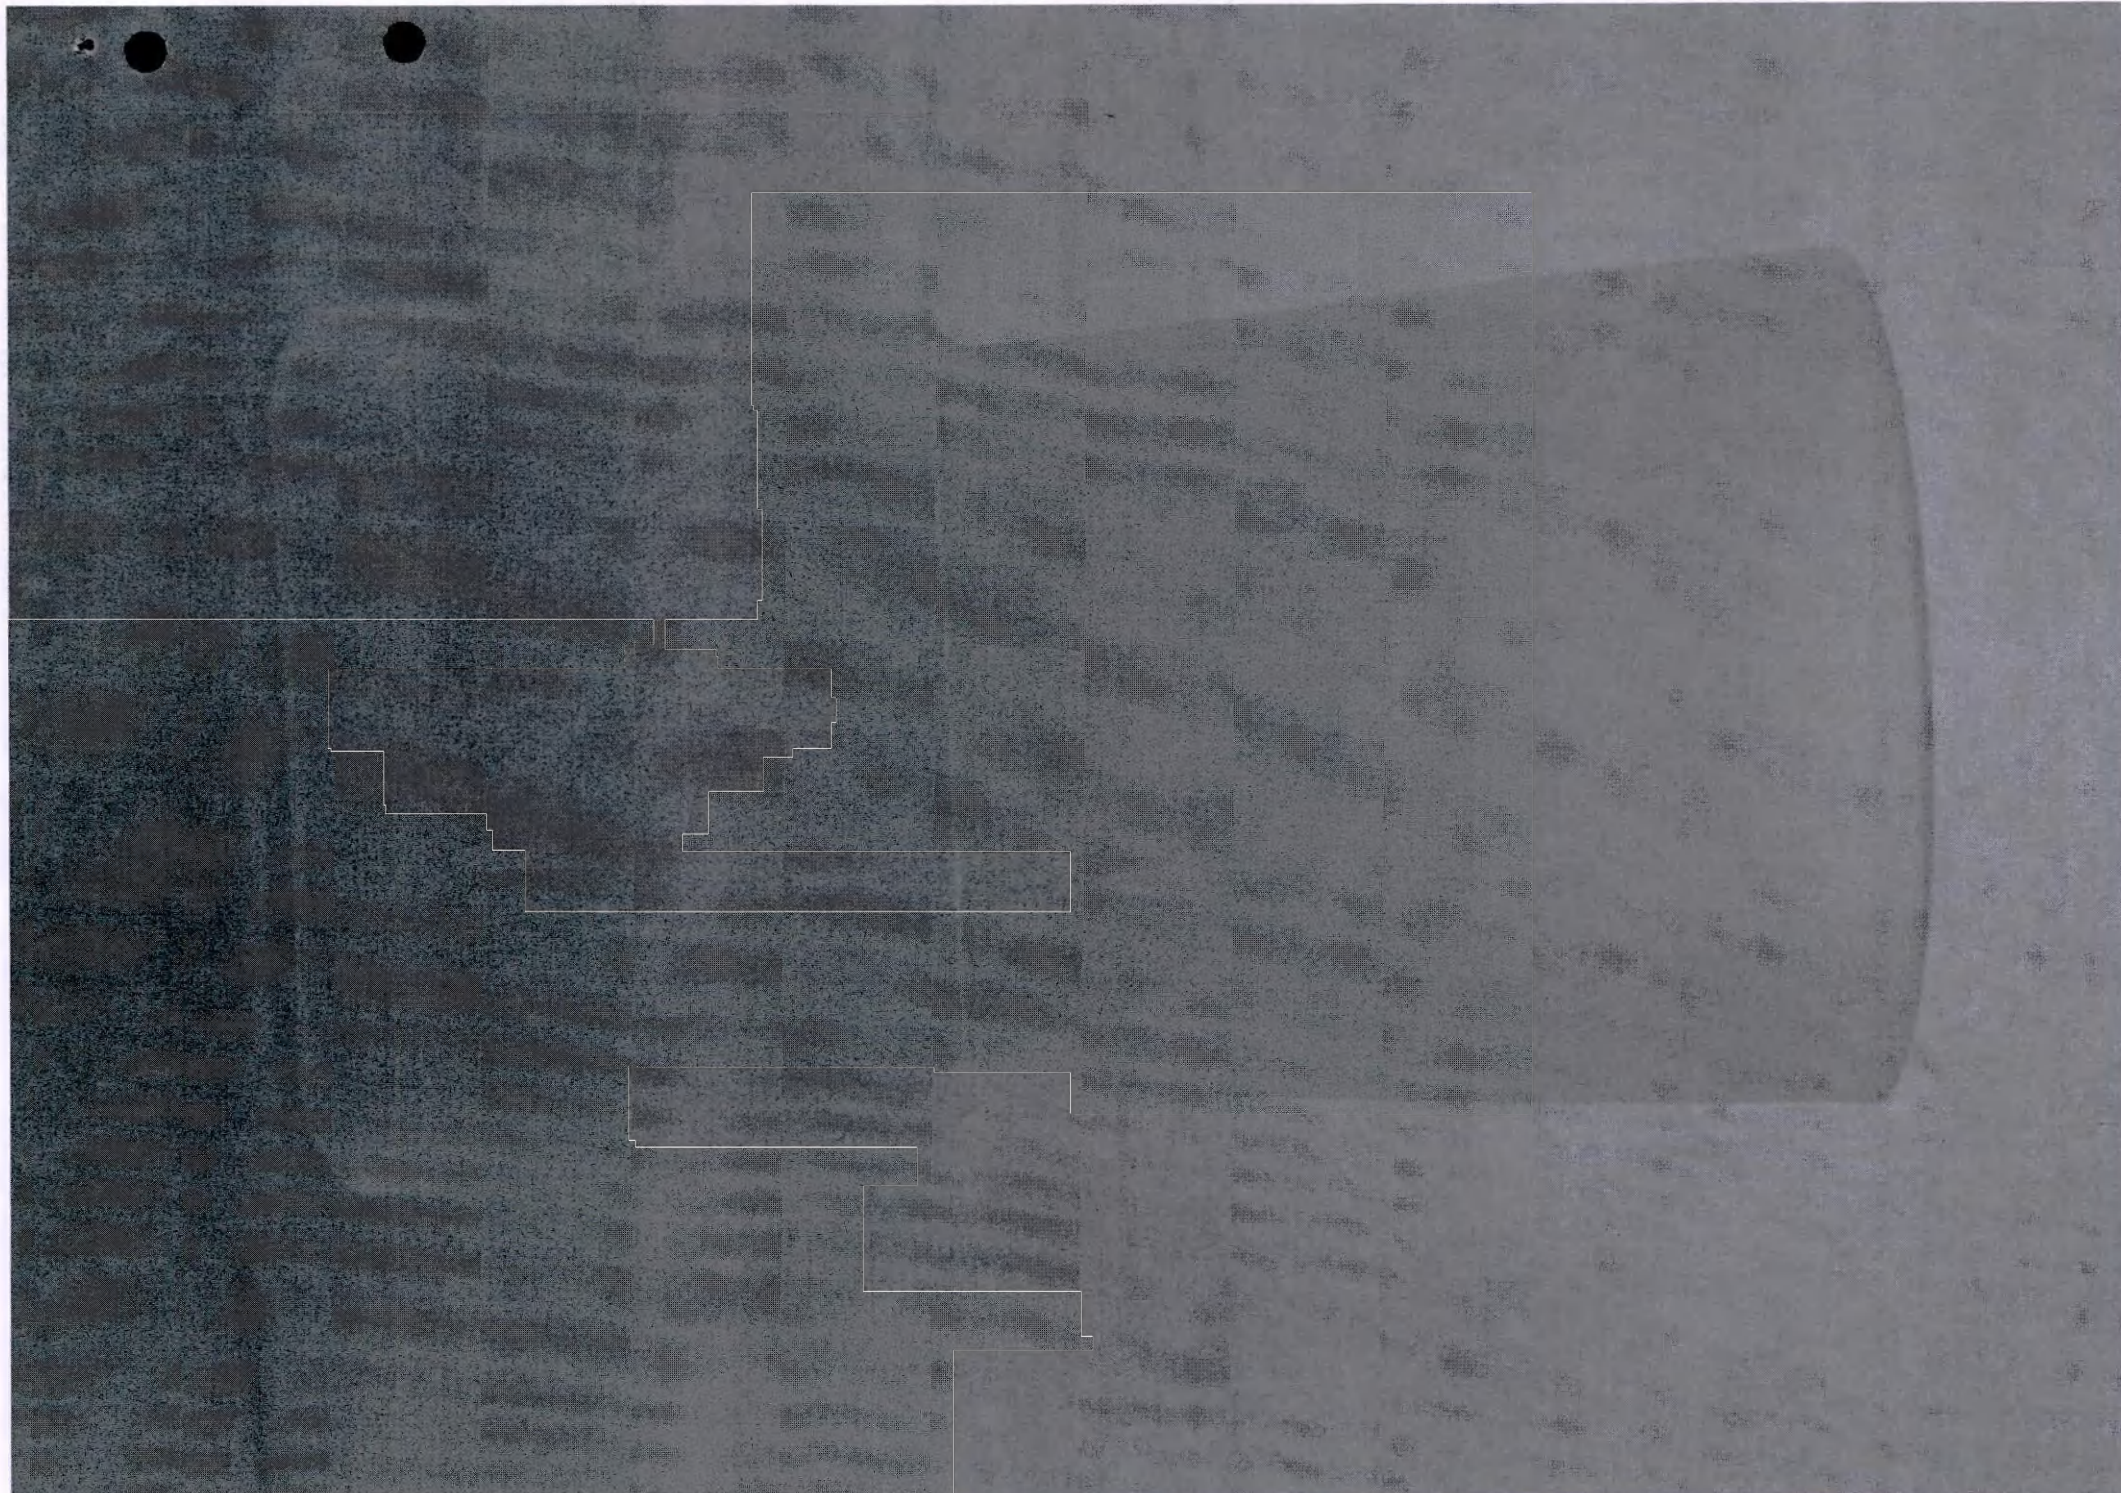

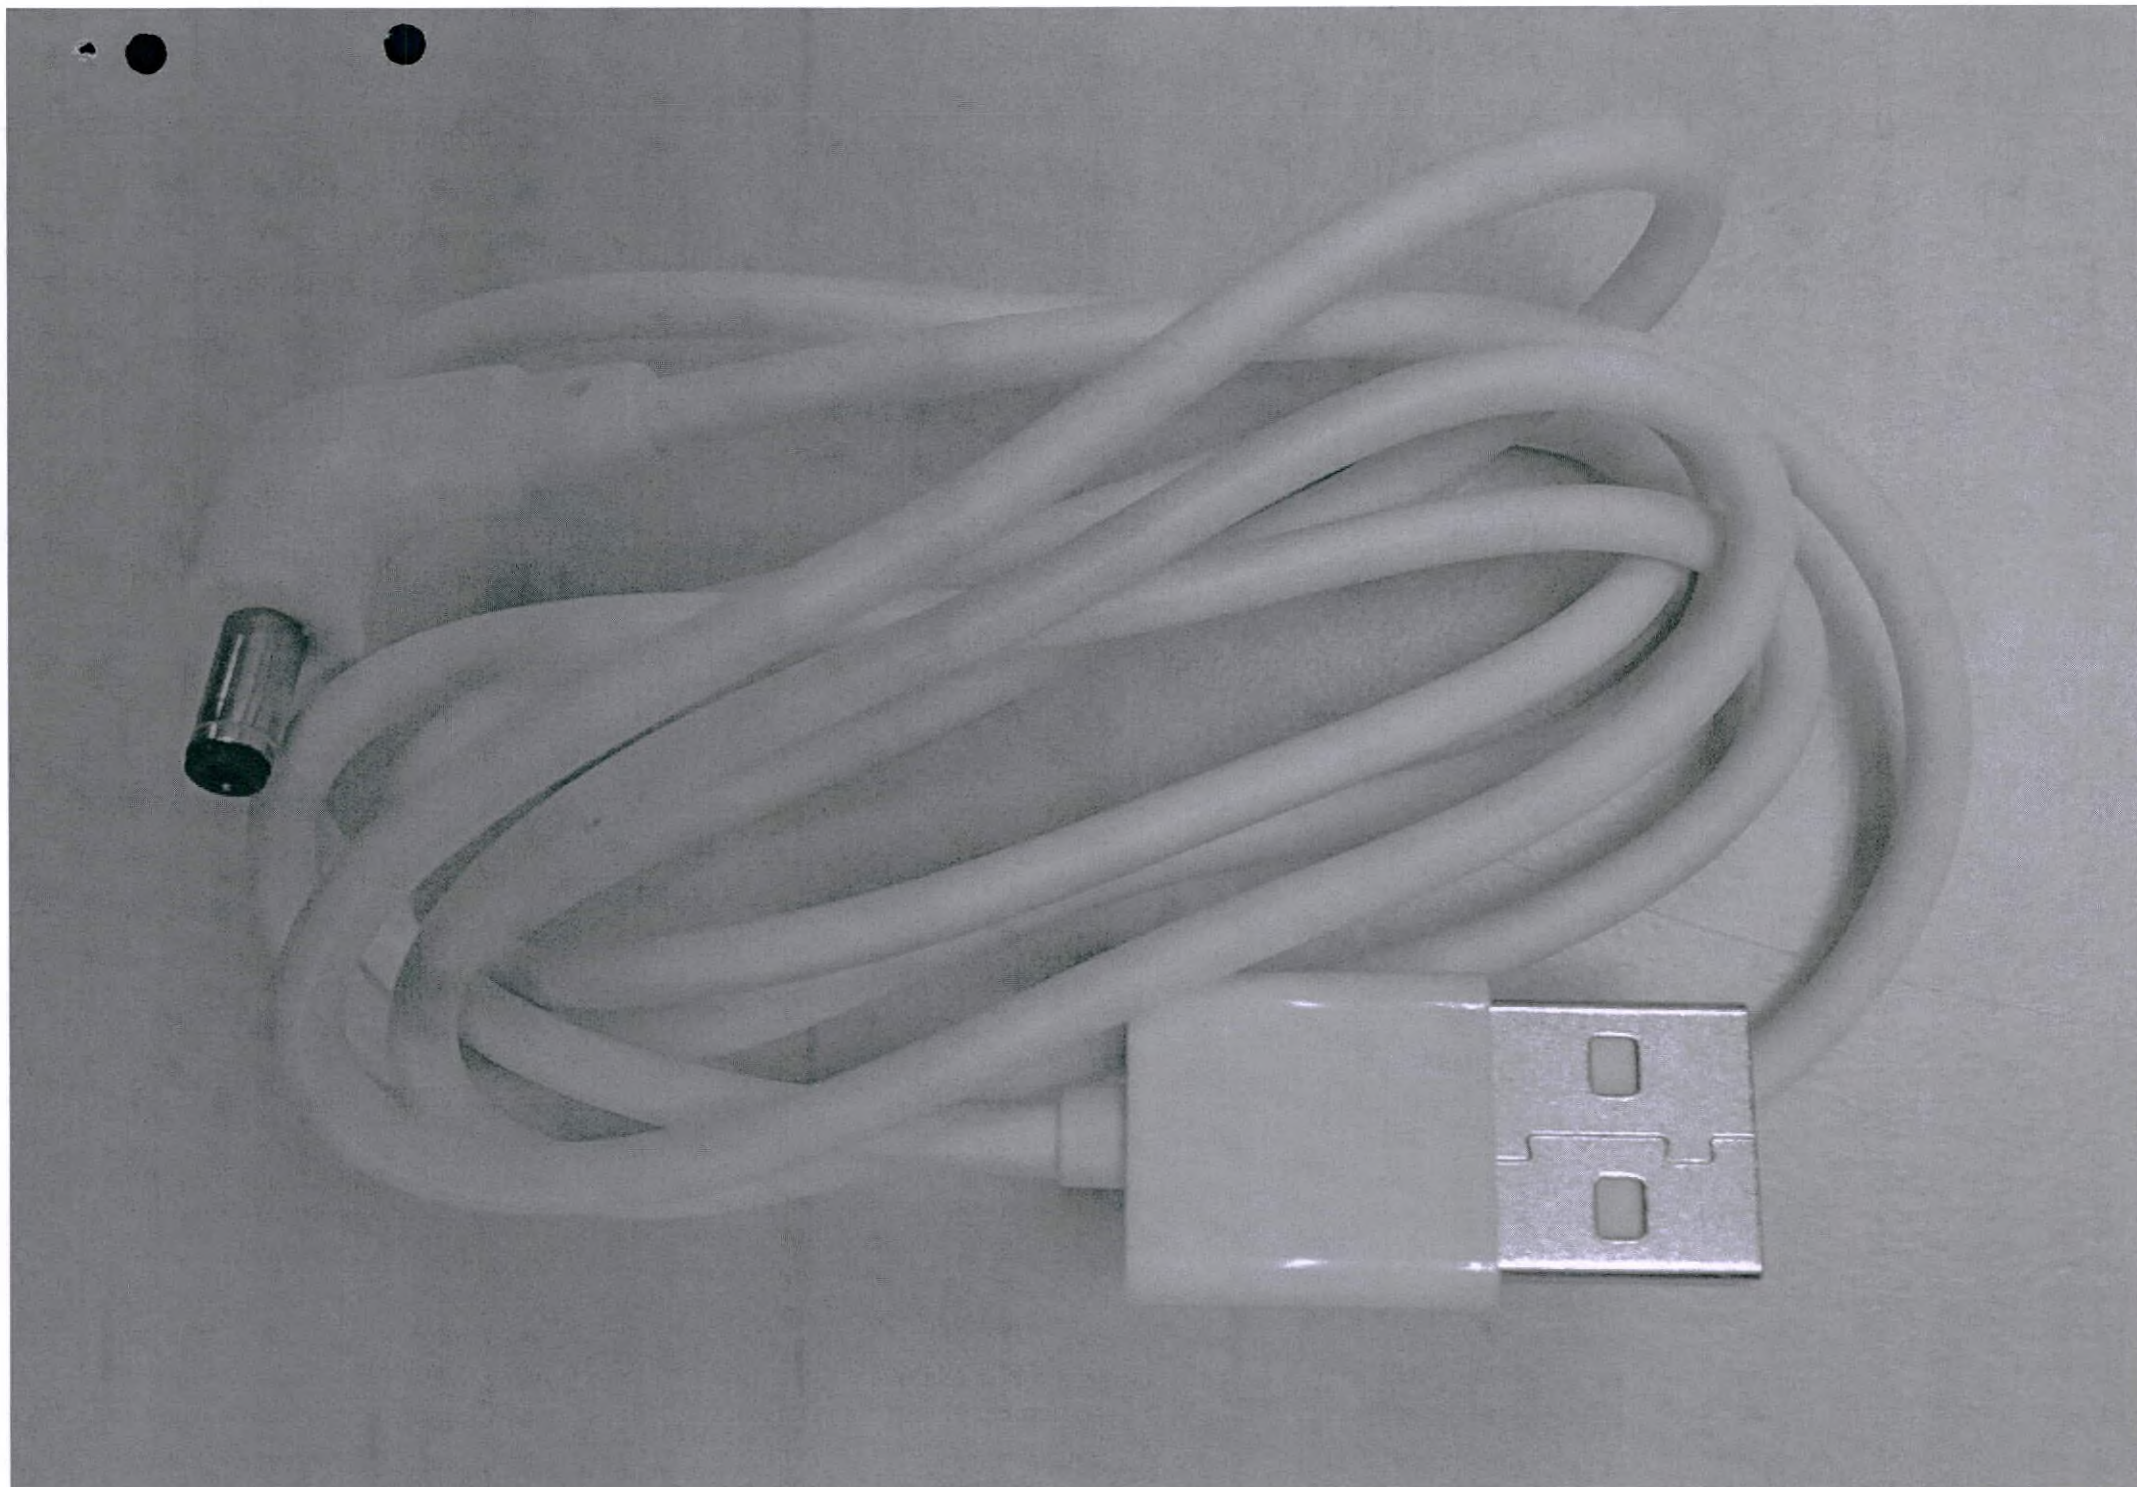

**Mesh-Небулайзер (ингалятор)
ультразвуковой «Armed»,
вариант исполнения M102
РУ № РЗН _____**

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical
Equipment & Supply Co., Ltd.

Элемент питания тип «АА» 1,5 В - 2 шт.

Потребляемая мощность: 1,9 Вт

SN: M10202301001



01.2023



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью ³⁶
тридцать шесть



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.