

Спирометр-В1 по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023

Макет шильдика на медицинское изделие

Спирометр-В1

TY 26.60.12-001-02923507-2023



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2



SN



Параметры питания

3,0 В постоянного тока (2 x 1,5 В щелочные батареи типа AAA), ≤ 80 мА

Степень защиты: IP22

py

Дата регистрации

Макет этикетки Мундштук одноразовый МР-01

Мундштук одноразовый

Модель: МР-01



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра Сколково
тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

LOT



Макет этикетки Мундштук одноразовый МР-02

Мундштук одноразовый

Модель: МР-02




ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра Сколково
тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

LOT



ДОКТИС 

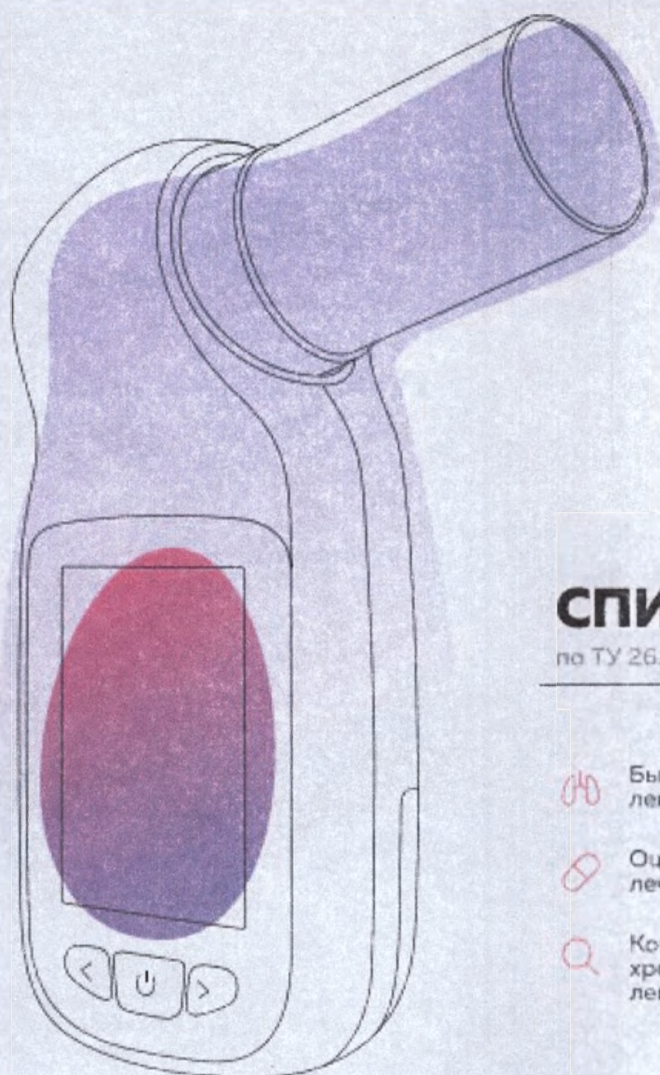

СПИРОМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023



Быстрое измерение объема
легких



Оценка эффективности
лечения в динамике



Контроль состояния при
хронических заболеваниях
легких

СПИРОМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023

Состав:

- Спирометр-B1 – 1 шт.
- Турбина – 1 шт.
- Мундштук одноразовый MP-01 – 1 шт.
- Батареи AAA – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства: ООО «БИПУЛЬС»

124489, г. Москва, г. Зеленоград, Ал. Сосновая, д. 6А, стр. 1, этаж 2, К16

LOT

Мундштук одноразовый MP-01



SN

Спирометр-B1



Мундштук одноразовый MP-01

Условия эксплуатации

- Температура от +10 до +35 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

Условия хранения и транспортировки

- Температура от +5 до +40 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

Параметры питания

3,0 В постоянного тока
(2 x 1,5 В щелочные батареи
типа AAA), ≤80мА

Степень защиты

IP22

РУ _____

Дата регистрации _____



<http://doctis.app/spiro>

ДОКТИС 

СПИРОМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023

ДОКТИС 

**С заботой о вашем
здоровье**



Инструкция



doctis.ru



8 800 500 0299



doctis_ru



devices@doctis.ru

СПИРОМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023

10 штук

Состав:

- Спирометр-B1 – 1 шт.
- Турбина – 1 шт.
- Мундштук одноразовый МР-01 – 1 шт.
- Батареи ААА – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства: ООО «БИПУЛЬС»

124489, г. Москва, г. Зеленоград, Ал. Сосновая, д. 6А, стр. 1, этаж 2, К16


Условия эксплуатации

- Температура от +10 до +35 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

Условия хранения и транспортировки

- Температура от +5 до +40 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

РУ _____ Дата регистрации _____

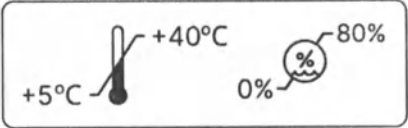



Пролито, пронумеровано и
окреплено печатью 5 листов.

Генеральный директор
ООО «ДМО»
_____ Лежнин С.А.

 doctis.ru

 8 800 500 0299

 doctis_ru

 devices@doctis.ru



Инструкция

ДОКТИС 


С заботой о вашем
здоровье

ДОКТИС 


СПИРОМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-001-02923507-2023

Спирометр – В1

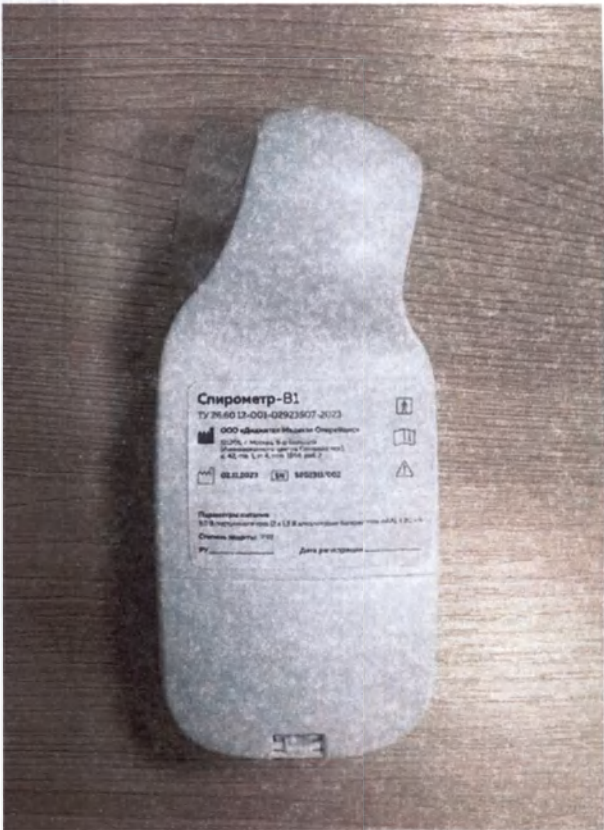

Турбина

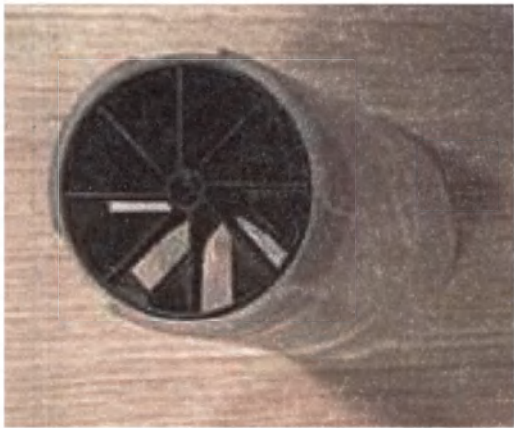

Батареи ААА




Мундштук одноразовый МР-01



Мундштук одноразовый МР-02



Фотографические изображения транспортной упаковки медицинского изделия

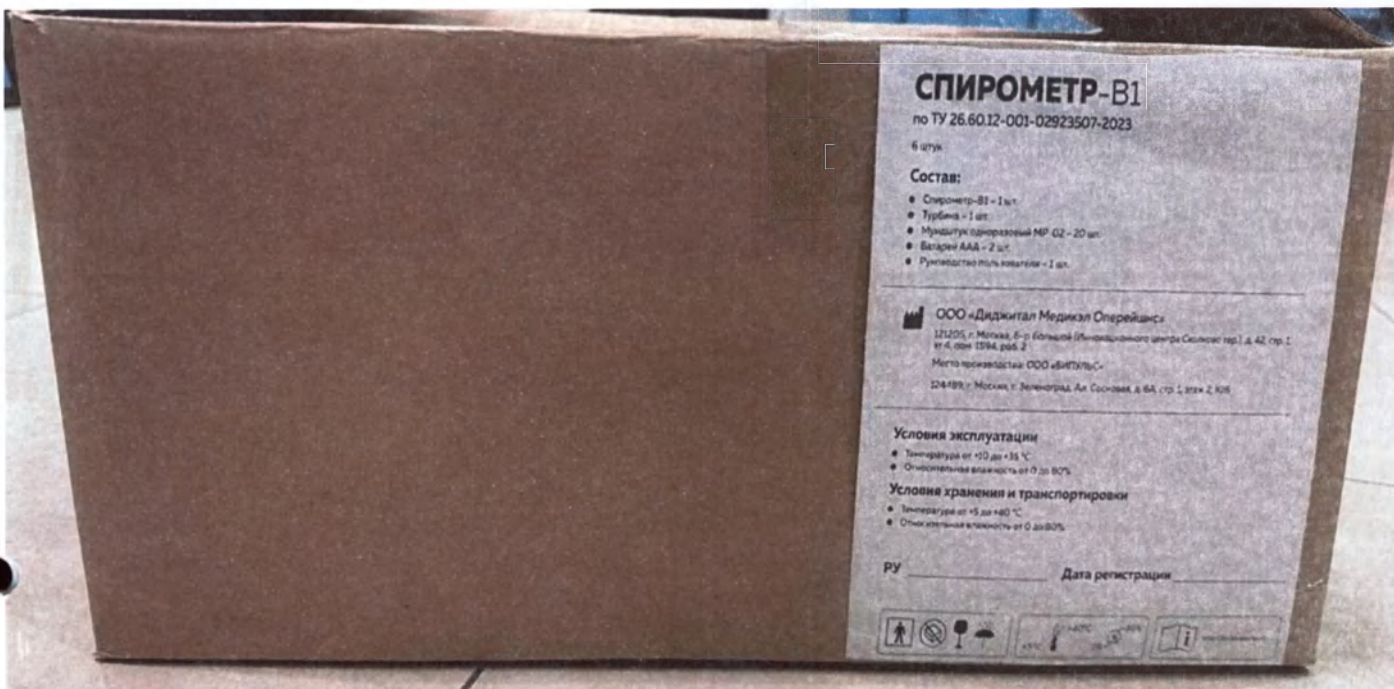

Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.

Генеральный директор

ООО «ДМО»

Лежнин С.А.

