

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»



Е.В. Варлыгин

«20» августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Анализатор мочи автоматический KU-2800»

Рисунок. Анализатор мочи автоматический KU-2800. Основной блок

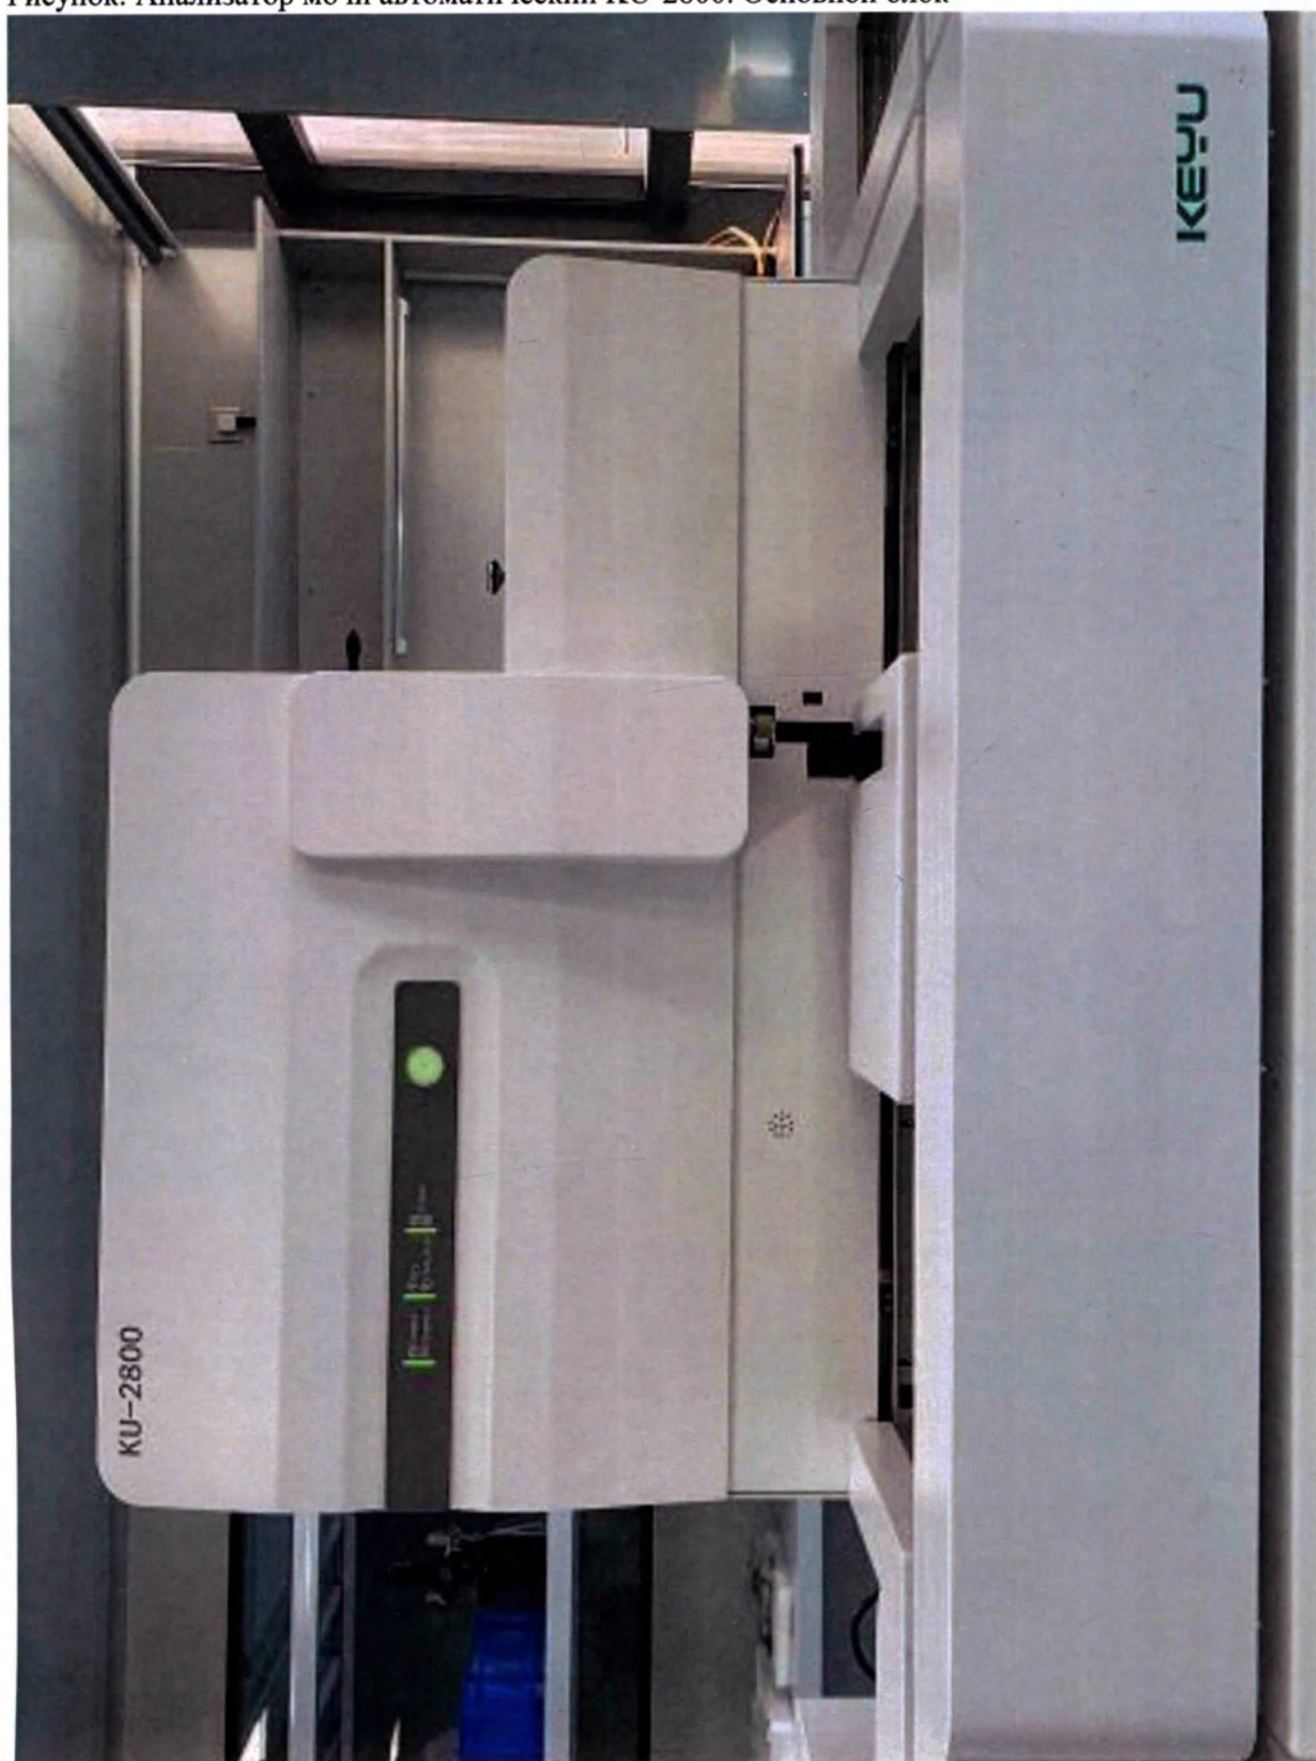


Рисунок. Монитор



Рисунок. Проводная клавиатура и мышь

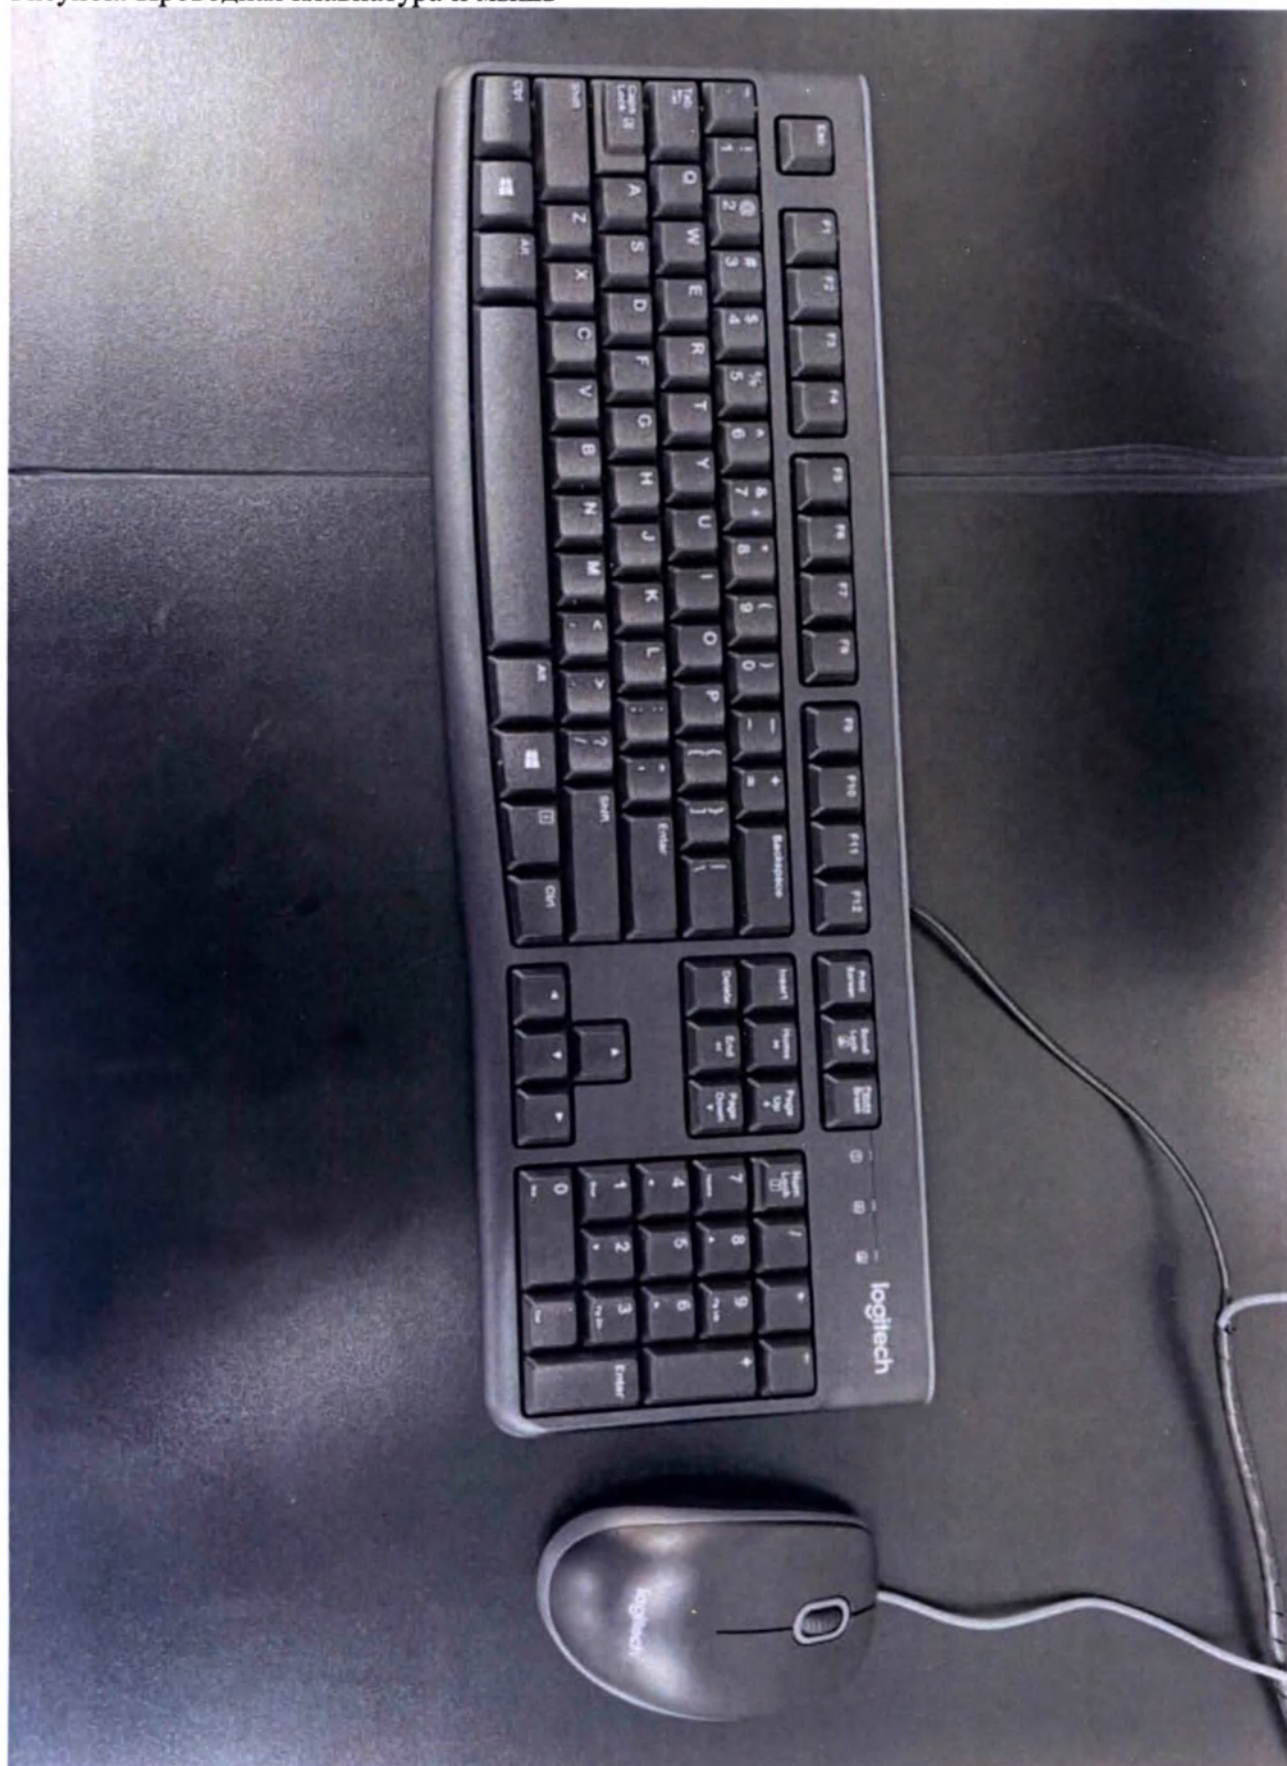


Рисунок. Руководство пользователя

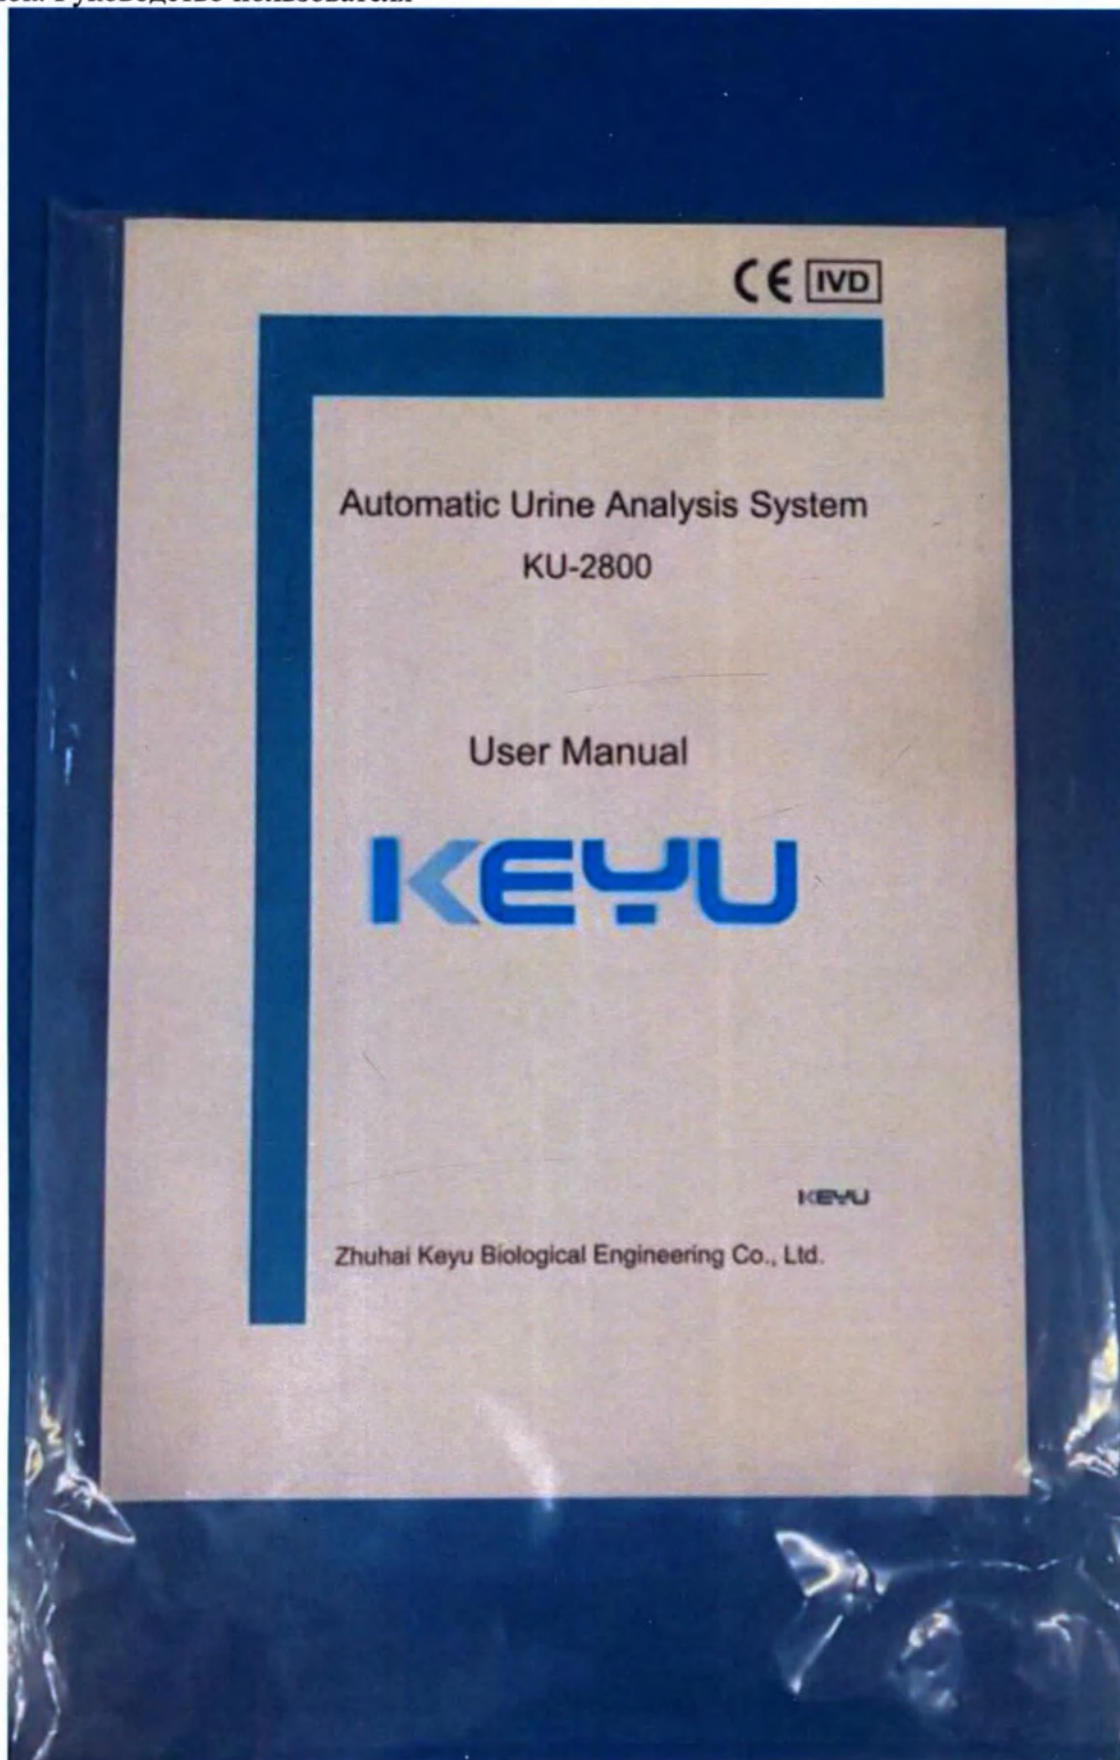


Рисунок. Лицензионный ключ

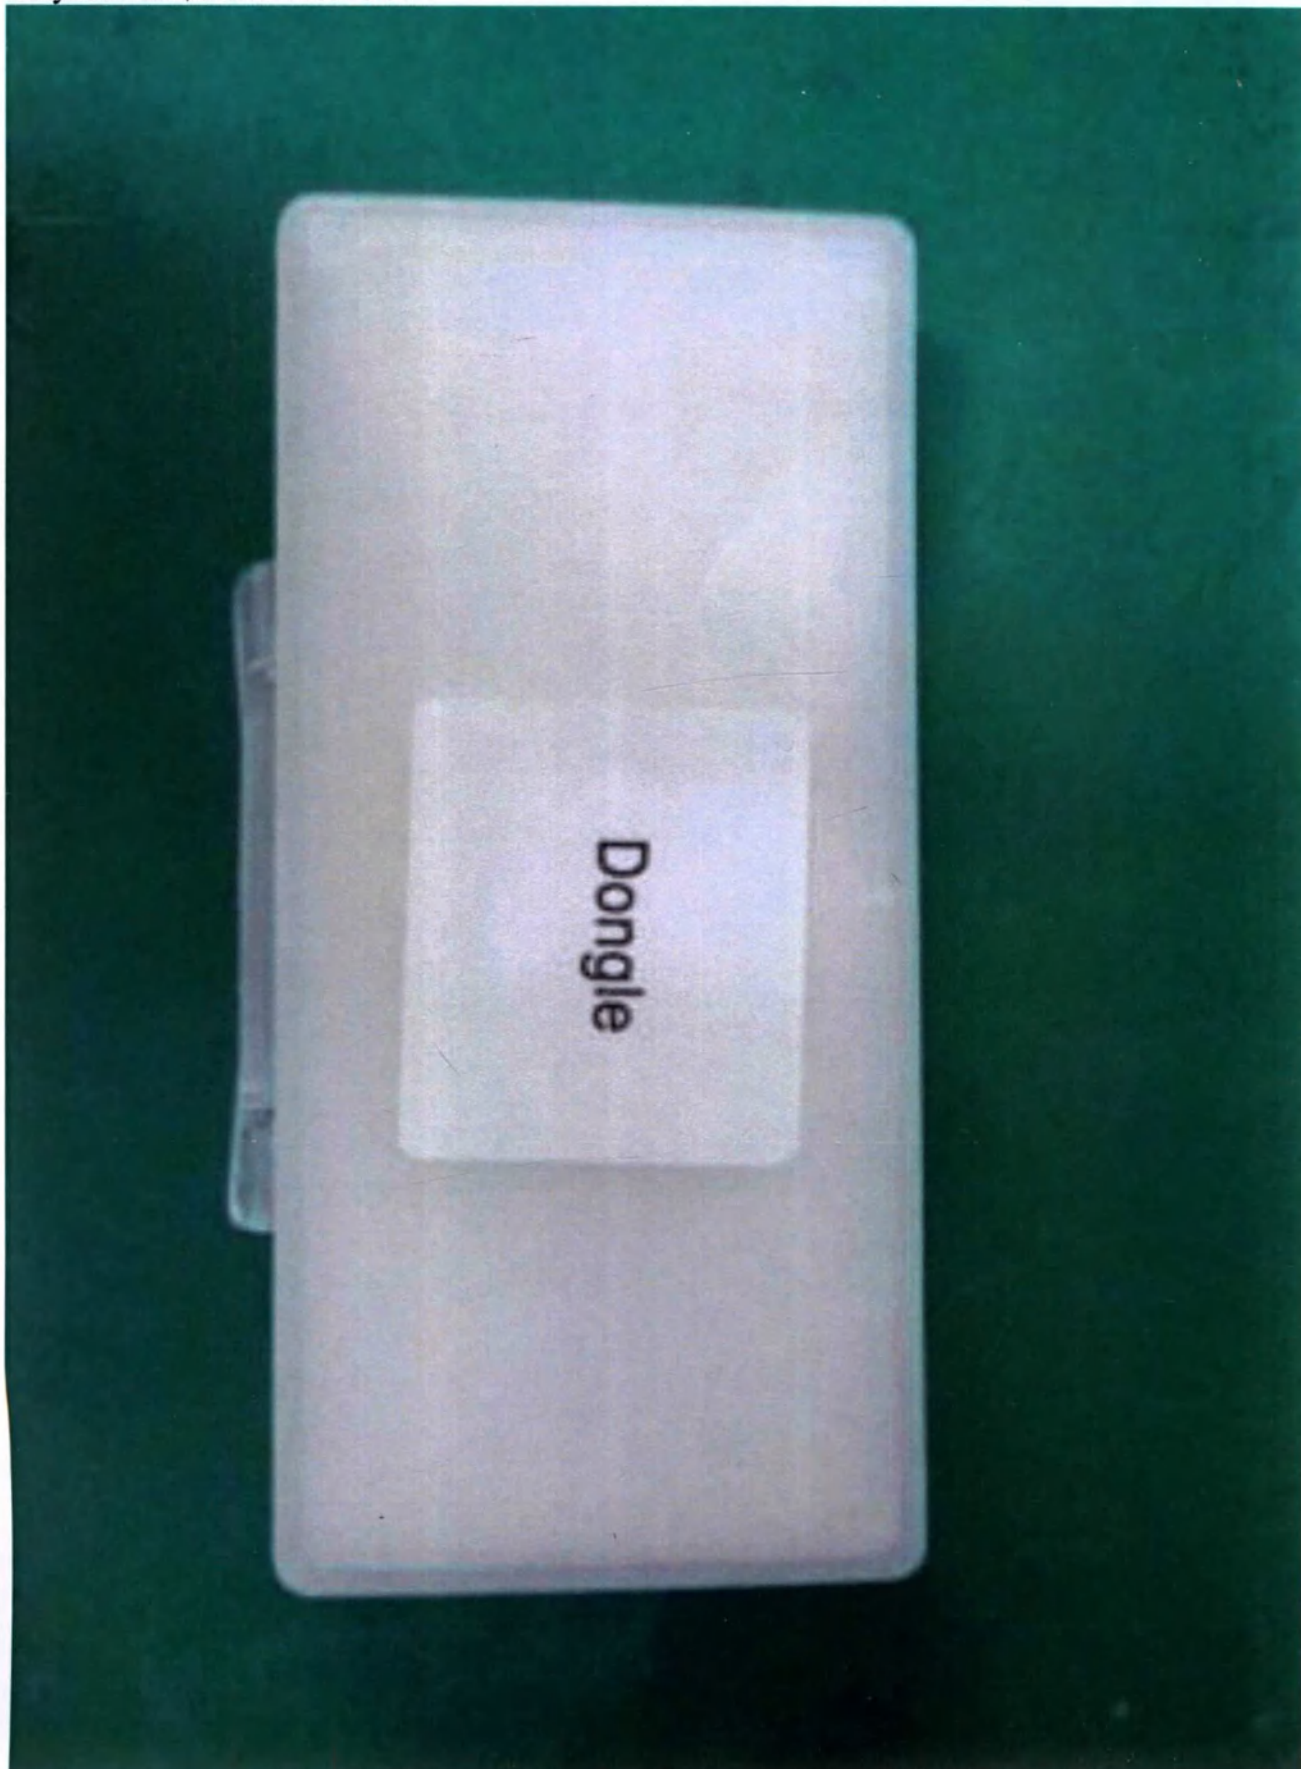




Рисунок. Шнур питания





Рисунок. Штатив для пробирок



Рисунок. Набор трубок



Рисунок. Набор трубок: Трубка для очищающего раствора



Рисунок. Набор трубок: Трубка для дилуента



Рисунок. Набор трубок: Трубка для жидких отходов



Рисунок. Набор трубок: Датчик переполнения емкости для отходов

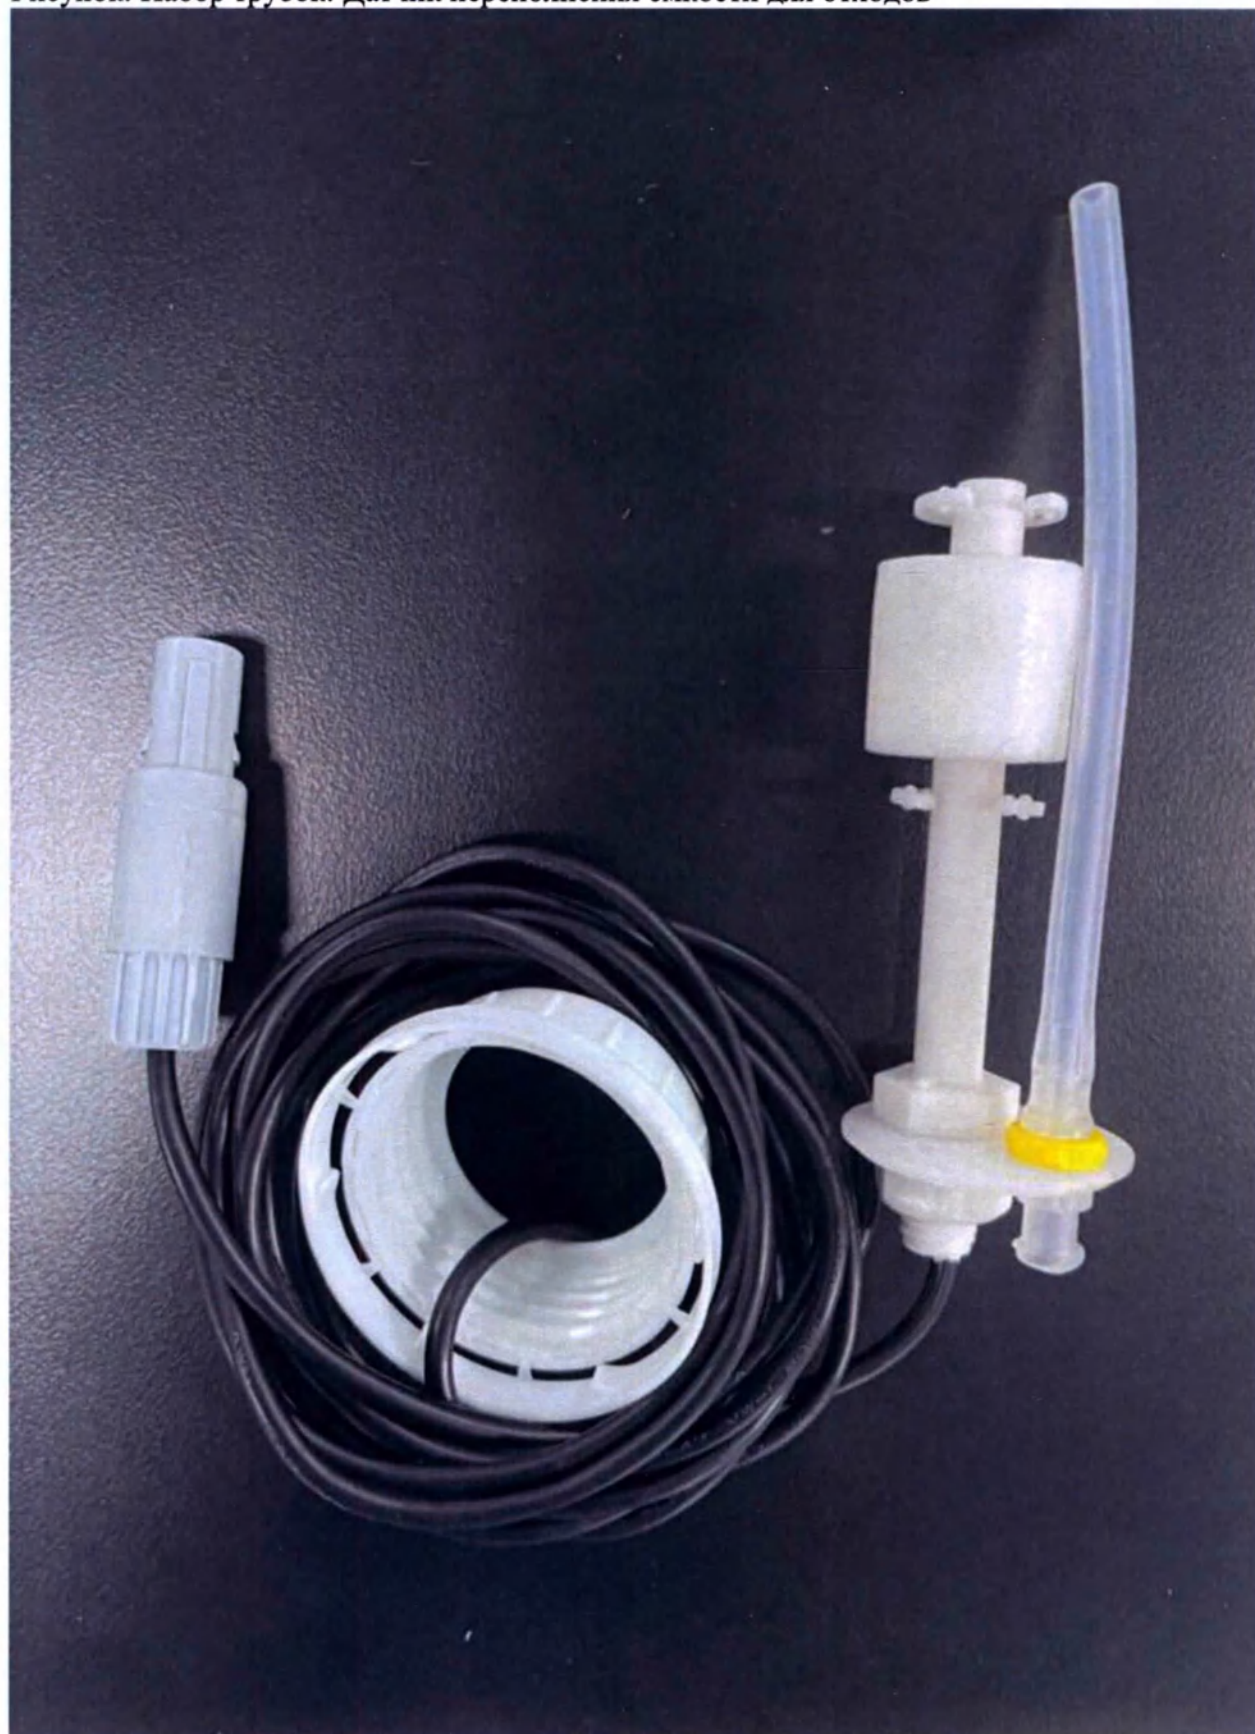


Рисунок. Бак для отходов, 5 л



Рисунок. Набор аксессуаров: Коврик для мыши

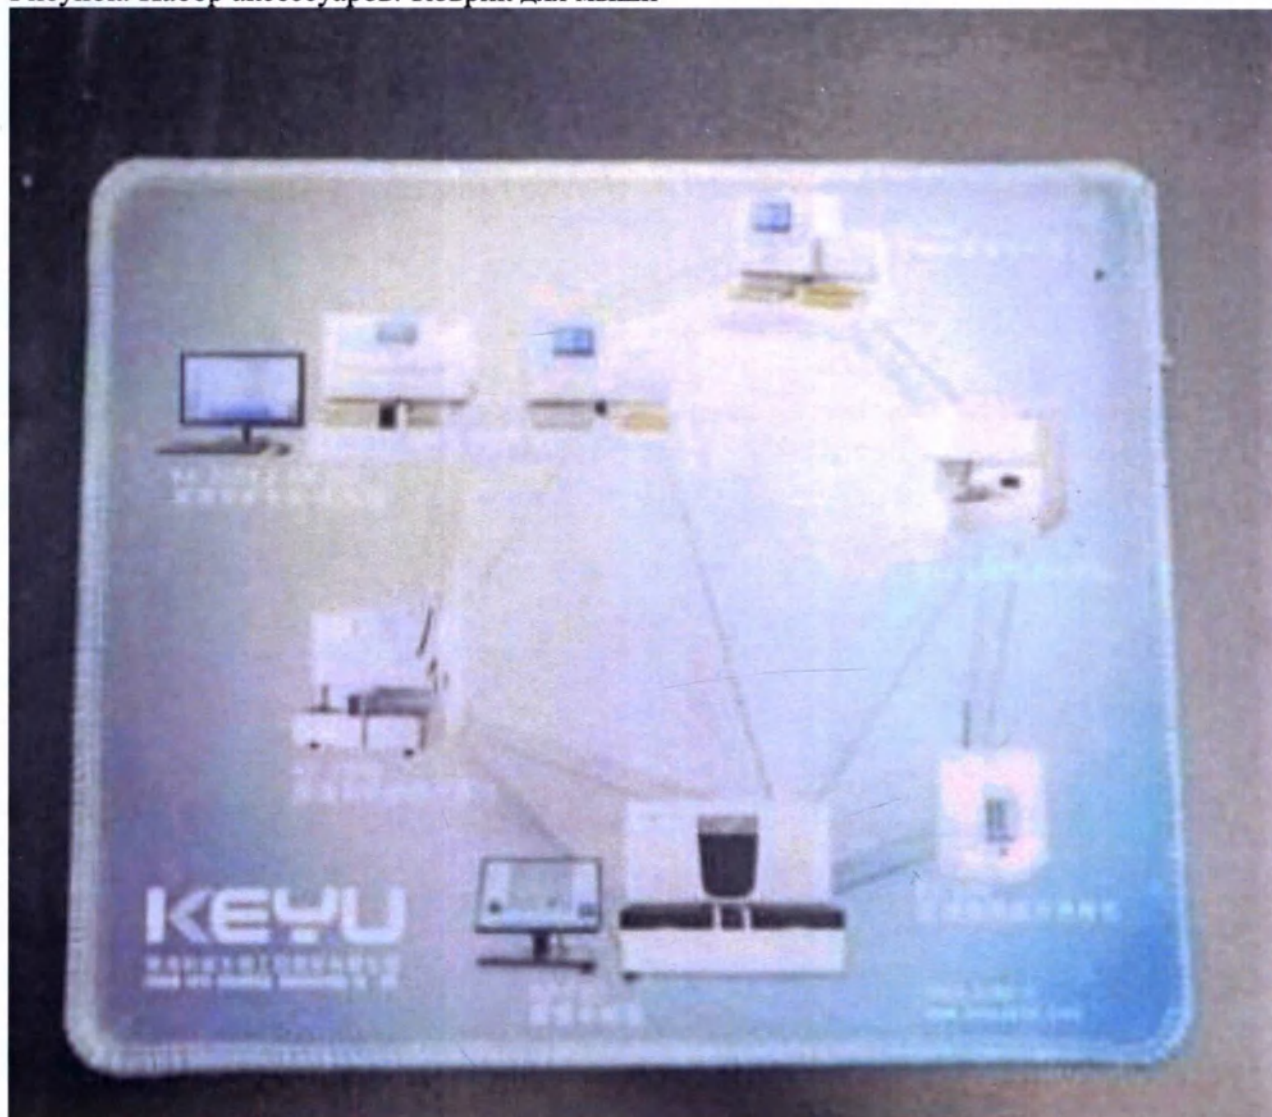


Рисунок. Набор аксессуаров: Футляр для карточки



Рисунок. Набор аксессуаров: Щетка



Рисунок. Набор аксессуаров: Набор калибровочных тест-полосок

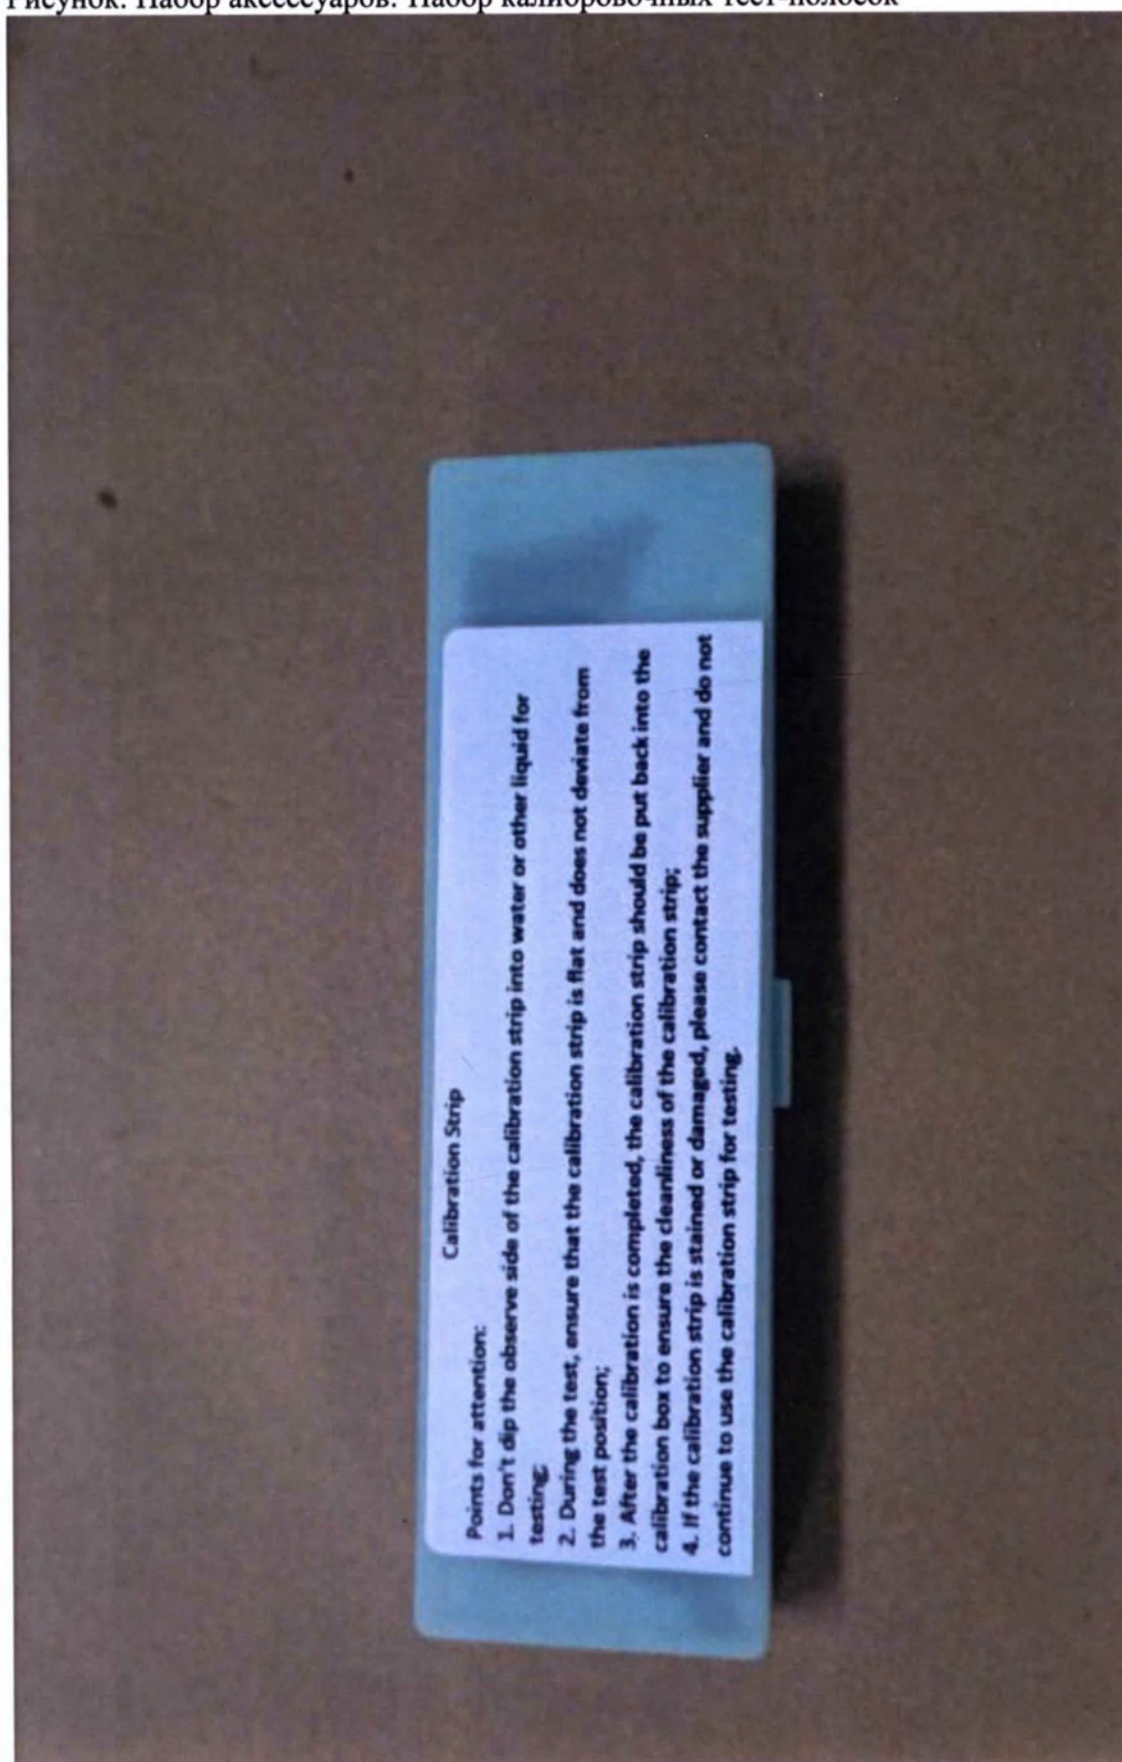


Рисунок. Набор аксессуаров: Груша для очистки оптической системы



Рисунок. Набор аксессуаров: Салфетка



Рисунок. Набор аксессуаров: Поглотитель влаги



Рисунок. Набор аксессуаров: Ватный тампон



Рисунок. Пробирки для анализа мочи



Рисунок. Модуль загрузки проб

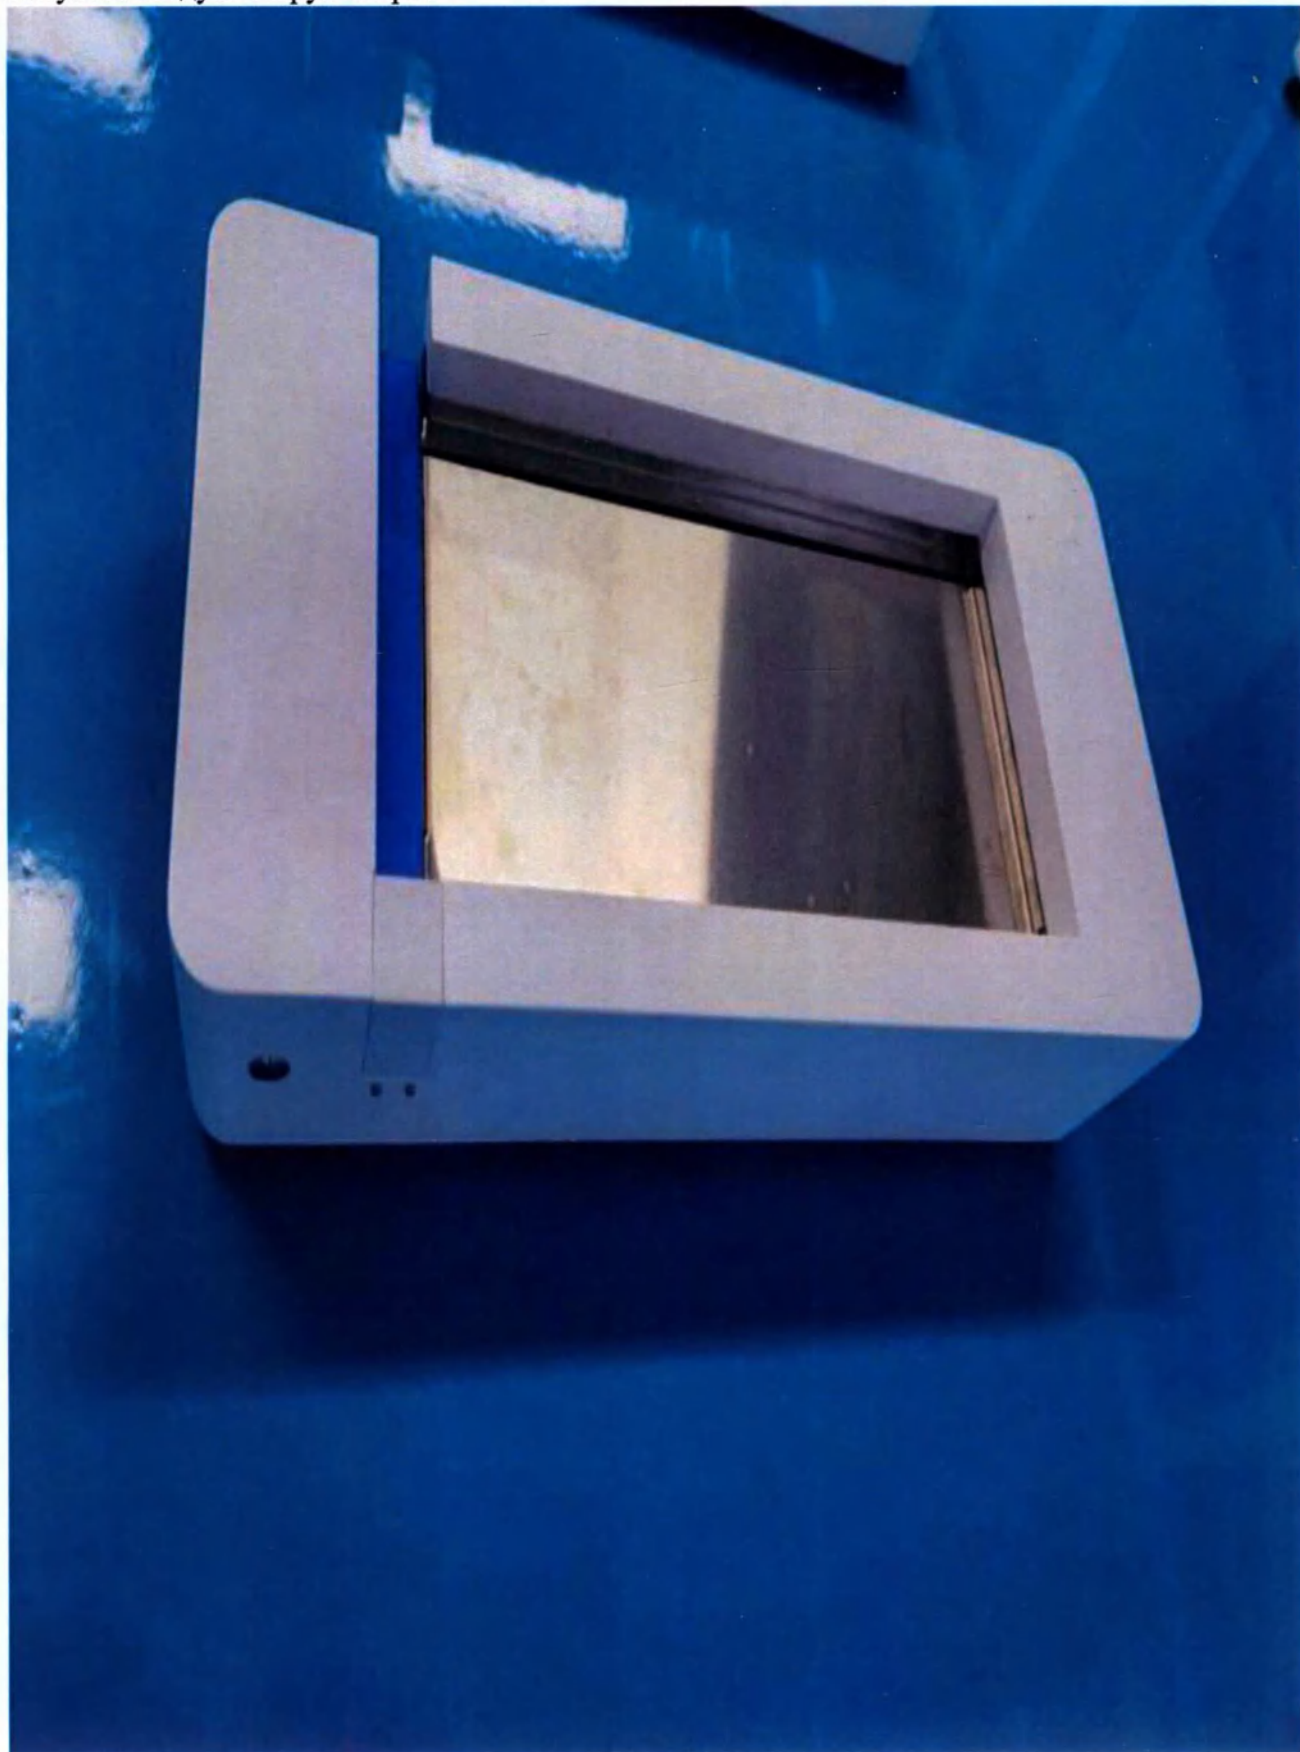


Рисунок. Модуль выгрузки проб


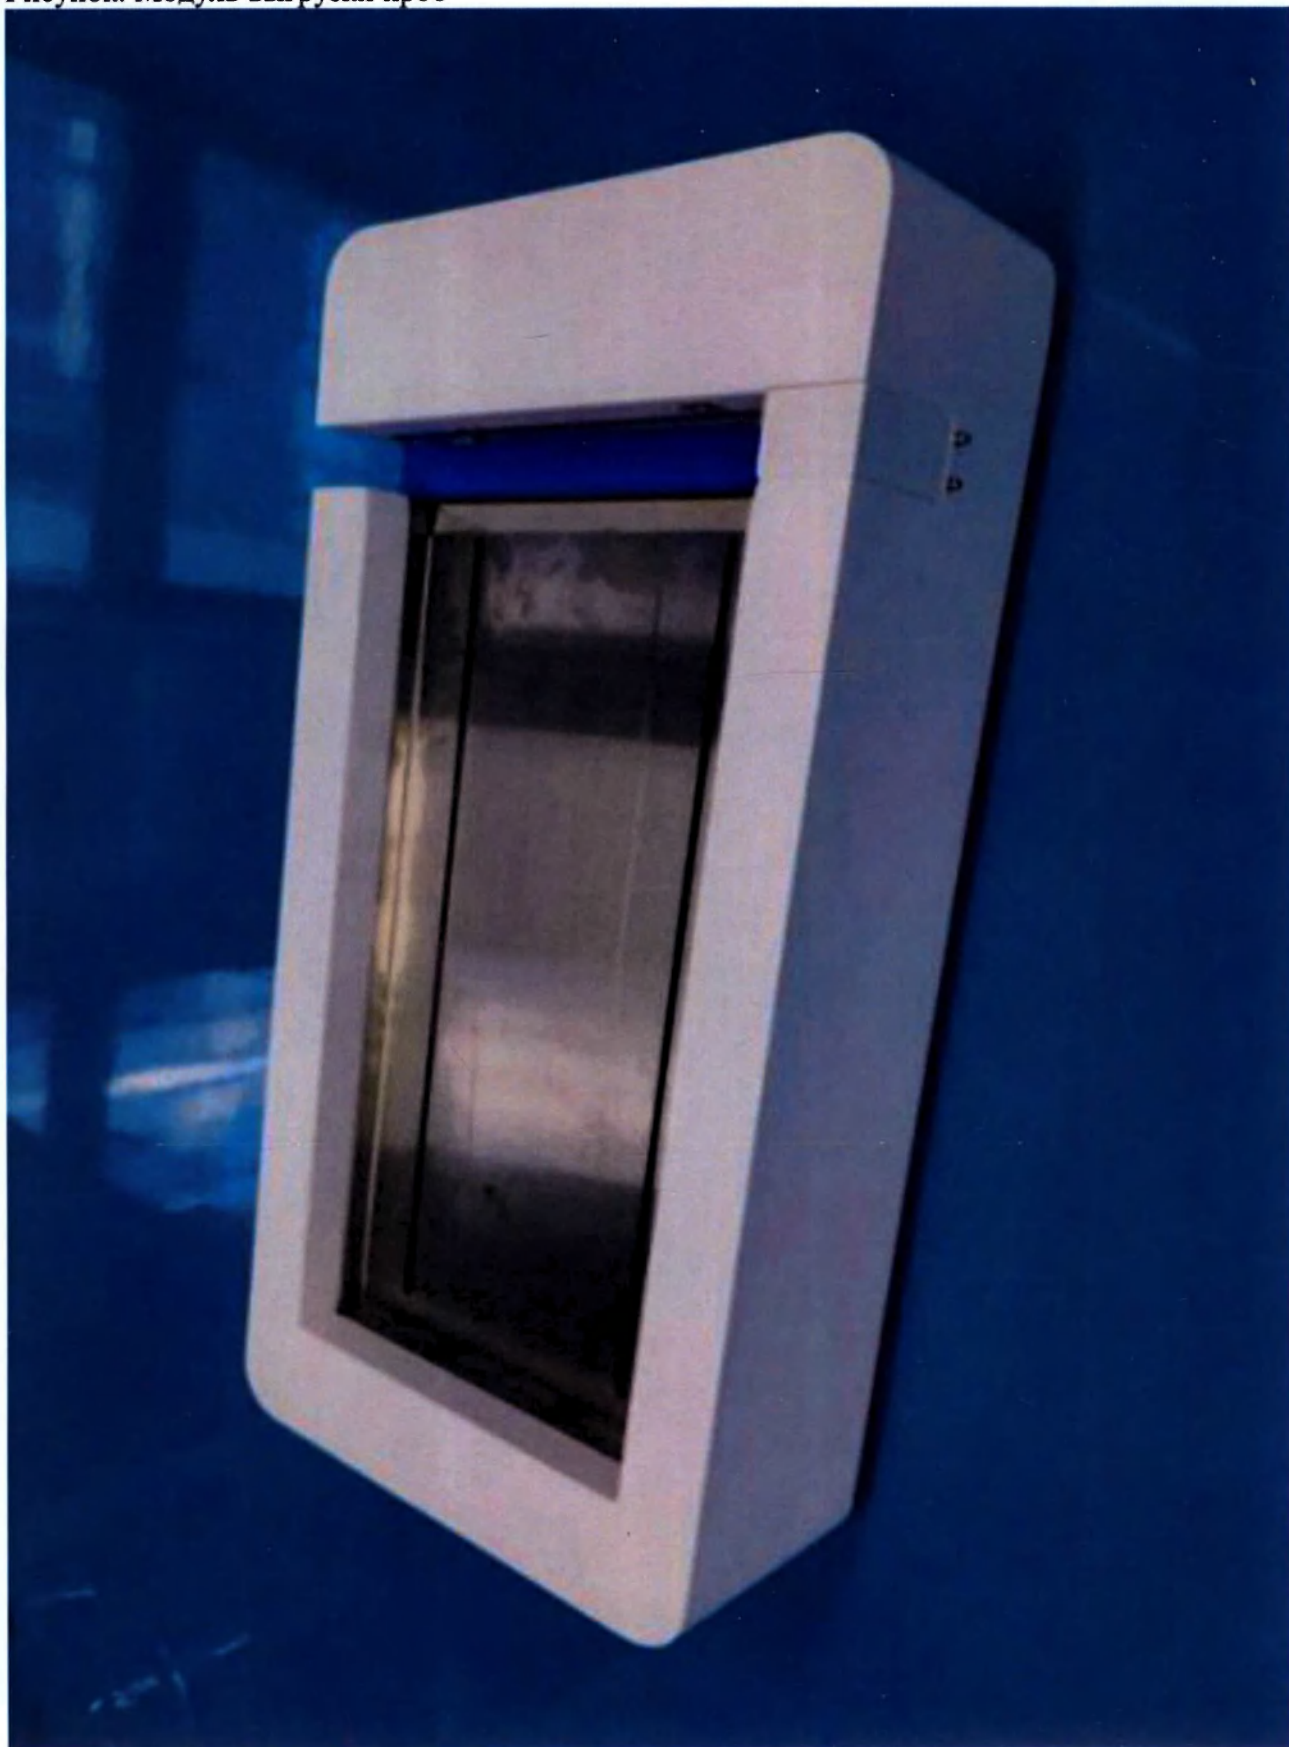


Рисунок. Соединительный мост



Рисунок. Управляющий компьютер

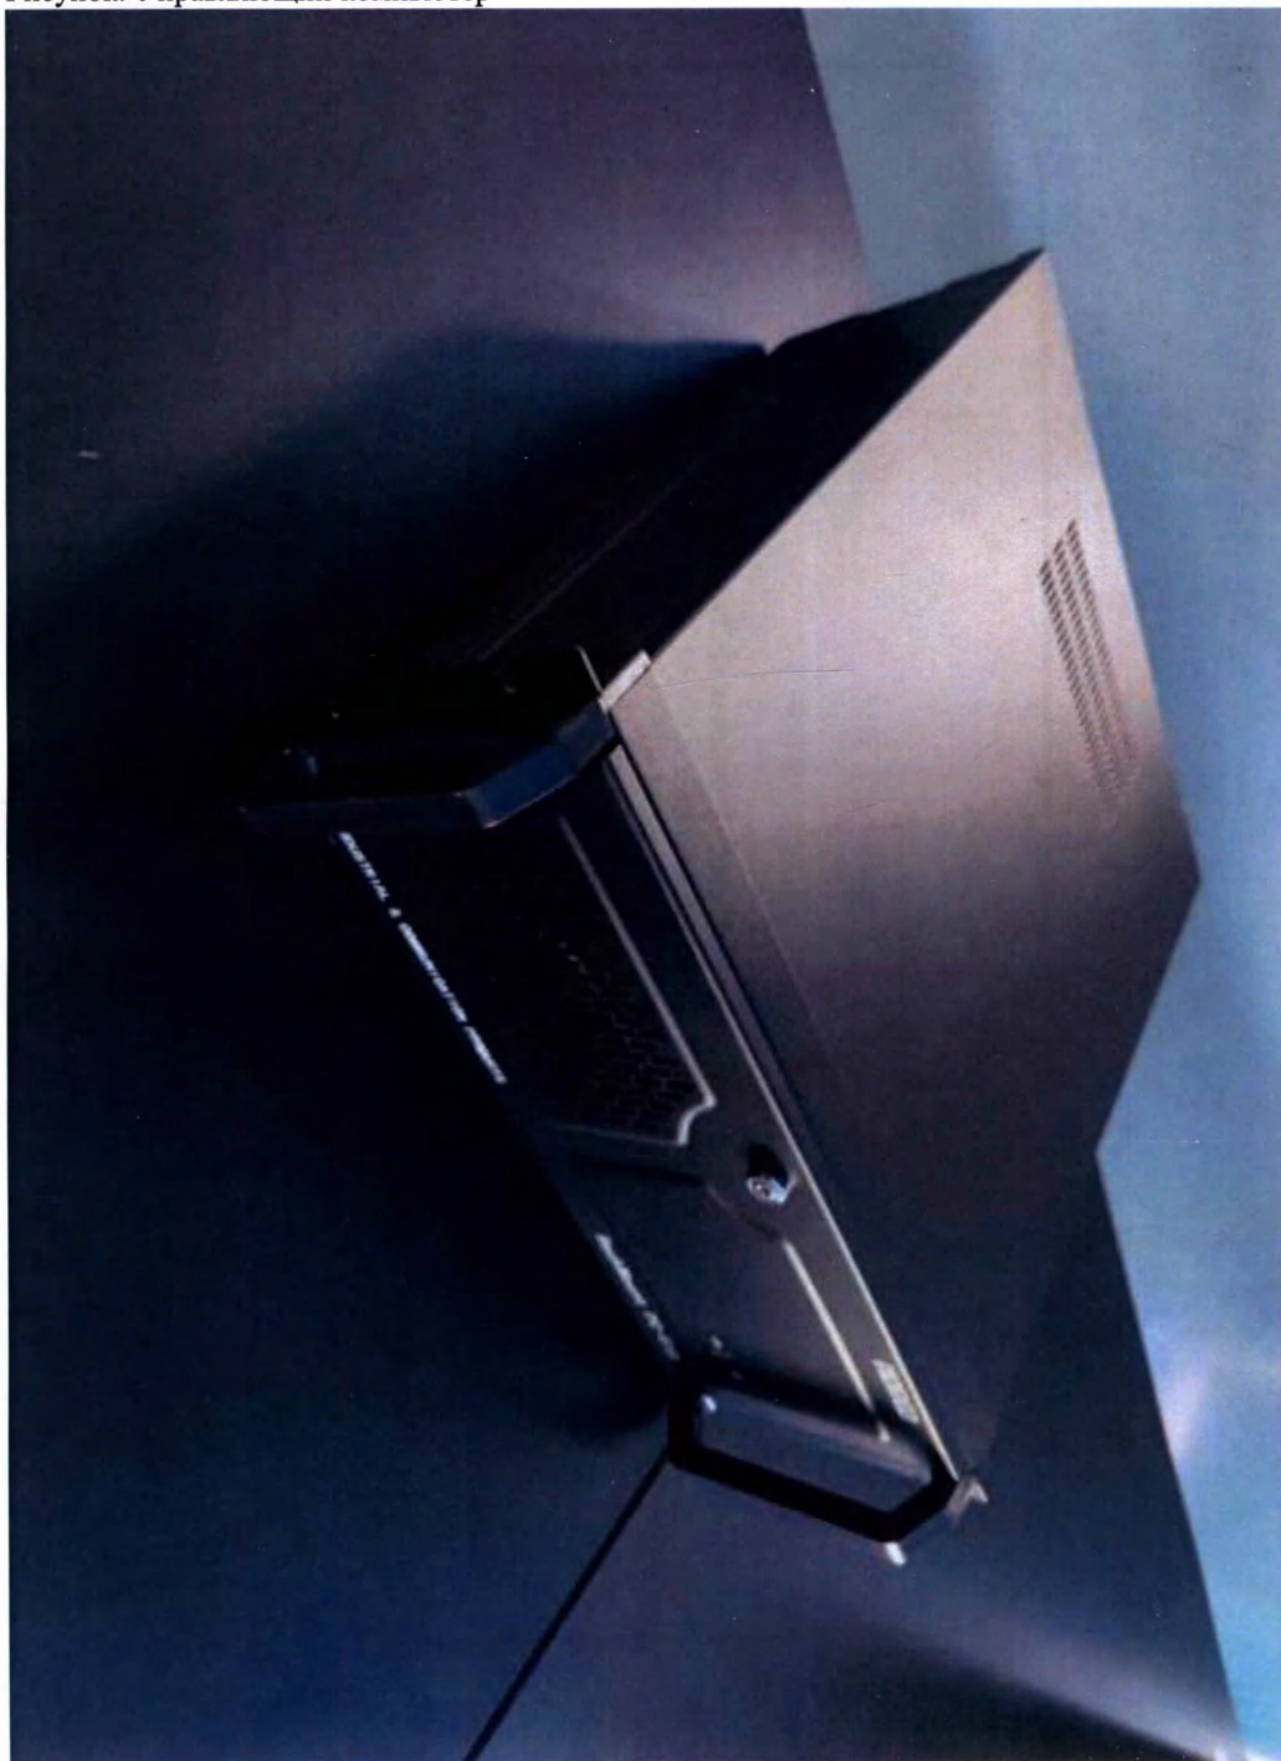

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Анализатор мочи автоматический KU-2800

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, дата производства и предупреждающие символы указаны на оригинальной маркировке изделия

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «КИФА»

109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3



XX.XX.XXXX

Параметры электропитания

Напряжение: Переменный ток (100-240 В) $\pm 10\%$ В

Частота: 50/60 Гц;

Потребляемая мощность: 600 $\pm 10\%$ ВА

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Анализатор мочи автоматический KU-2800

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Серийный номер, дата производства и предупреждающие символы указаны на оригинальной маркировке изделия

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «КИФА»

109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Условиях хранения и транспортирования – Температура окружающей среды: -10~40 °С,

Относительная влажность: не более 93%.

Габаритные размеры – 1030 x 915 x 890 мм

Масса - 140 кг ± 5 кг

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31/Директор «КИФА» лист(-ов),
Генеральный директор ООО «КИФА»



Е.В.Варлыгин