

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

 Радюшкин И.В.
«20» 03 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**


производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

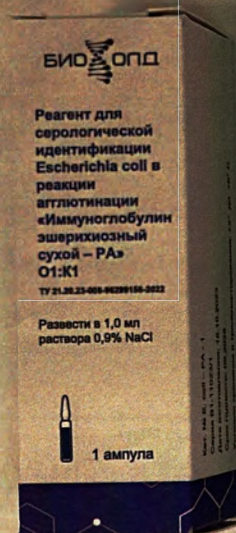

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O1:K1
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 1
РУ № _____

Серия В1- 10617/1
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O151:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более ,
Показатель оптический
Иммуноглобулина сухого – РА при разв
0,9 % р-ра NaCl при д
нм, ед. опт. пл., в диап
Микробиологическая
Иммуноглобулина эше



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

1 ампула

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

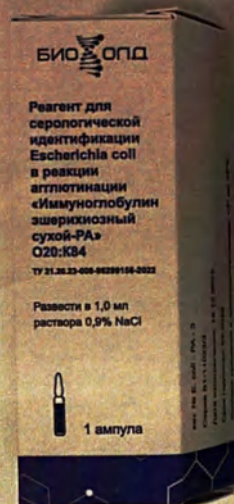

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O20:K84
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 3
РУ № _____

Серия В1- 10617/3
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой - РА O20:K84
2. Технические характеристики
Растворимость Иммуноглобулина сухого – РА не более
Показатель оптич. Иммуноглобулина сухого – РА при р 0,9 % р-ра NaCl пр нм, ед. опт. пл., в д



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

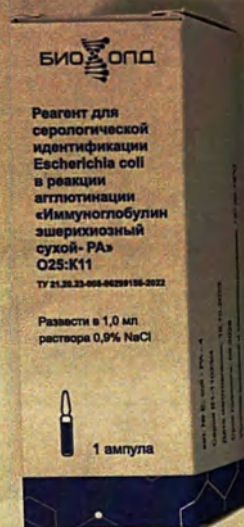

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» O25:K11
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli - РА - 4
РУ № _____

Серия В1- 10617/4
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой - РА O25:K11
2. Технические характеристики
Растворимость Иммуноглобулина сухого - РА не бол
Показатель опти Иммуноглобулина сухого - РА при 0,9 % р-ра NaCl п нм, ед. опт. пл, в д
Микробиологичес Иммуноглобулина сухого - РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O47:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °C.

Результаты контроля

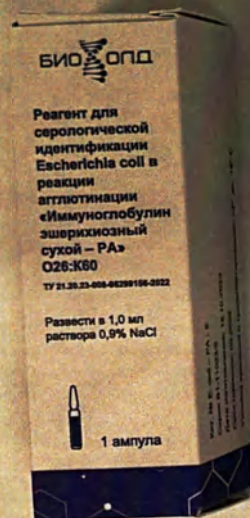

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» O26:K60
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli - РА - 5
РУ № _____

Серия В1- 10617/5
Дата изготовления _____

Наименован
1.Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O26:K60
2.Технические ха
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого - РА не бол
Показатель опти
Иммуноглобулина
сухого - РА при р
0,9 % р-ра NaCl п
нм, ед. опт. пл., в д
Микробиологическ
Иммуноглобулина



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia
coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

1 ампула

ООО ЦРПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

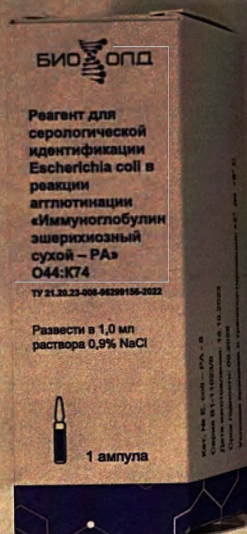

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O44:K74
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 8
РУ № _____

Серия В1- 10617/8
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O44:K74
2. Технические характ
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не более , м
Показатель оптическ
Иммуноглобулина
сухого – РА при разве
0,9 % р-ра NaCl при д
нм, ед. опт. пл., в диапа
Микробиологическая ч



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

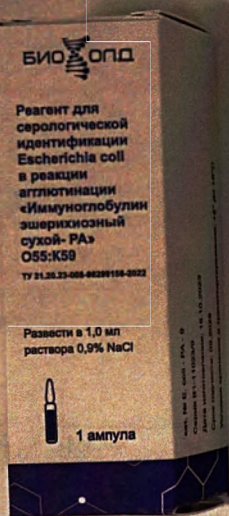

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O55:K59
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 9
РУ № _____

Серия В1- 10617/9
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой - РА O55:K59
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более
Показатель оптич
Иммуноглобулина сухого – РА при р
0,9 % р-ра NaCl пр
нм, ед. опт. пл., в д
Микробиологическ
Иммуноглобулина з



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia
coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

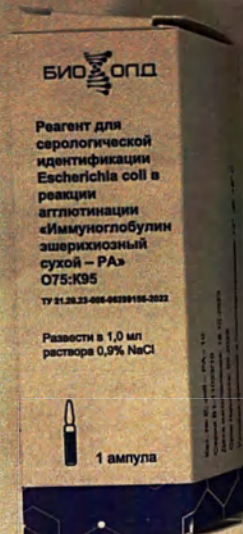

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O75:K95
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 10
РУ №

Серия В1- 10617/10
Дата изготовления

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O75:K95
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более, мг
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина сухого – РА при разведении 0,9 % р-ра NaCl при длине волны 540 нм, ед. опт. пл., в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина эшерихиозного



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

результаты
контроля

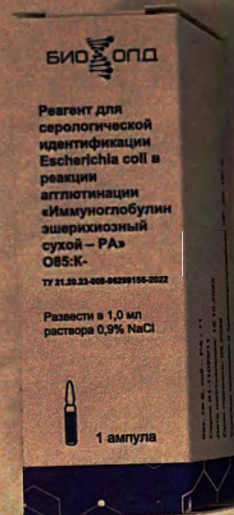

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» O85:K-
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli - РА - 11
РУ № _____

Серия В1- 10617/11
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O85:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого - РА не более
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина
сухого - РА при разв.
0,9 % р-ра NaCl при 540 нм, ед. опт. пл., в дим.
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина эшерихиозного



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

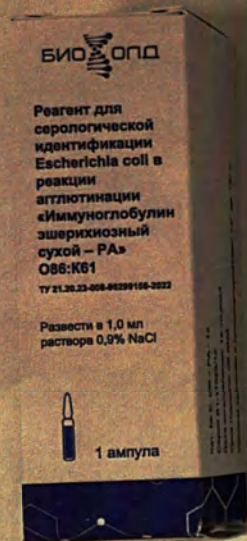

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O86:K61

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 12
РУ № _____

Серия В1- 10617/12
Дата изготовления _____

Наименован
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O86:K61
2. Технические ха
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не бол
Показатель опти
Иммуноглобулина
сухого – РА при р
0,9 % р-ра NaCl п
нм, ед. опт. пл., в д
Микробиологичес
Иммуноглобулина
сухого – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia
coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

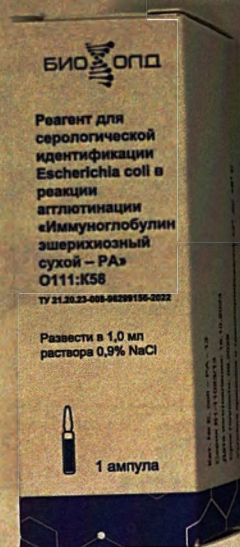

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O111:K58
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 13
РУ № _____

Серия В1- 10617/13
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O111:K58
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина сухого – РА при разв. 0,9 % р-ра NaCl при 480 нм, ед. опт. пл., в дисперсии
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина сухого – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.


Результаты контроля

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O112:K66

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 14
РУ №

Дата изготовления _____

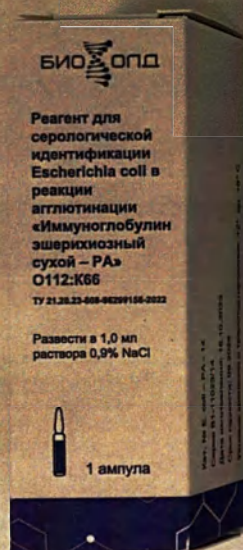

Наименование		Результаты контроля
1. Внешний вид		
Иммуноглобулин сухой - РА О112:K66		
2. Технические характеристики		
Растворимость Иммуноглобулина сухого - РА не более		
Показатель оптической плотности Иммуноглобулина сухого - РА при разбавлении 0,9 % р-ра NaCl при 600 нм, ед. опт. пл., в диаметре 1 см		
Микробиологическая чистота Иммуноглобулина эшерихиозного - РА		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О- и К-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

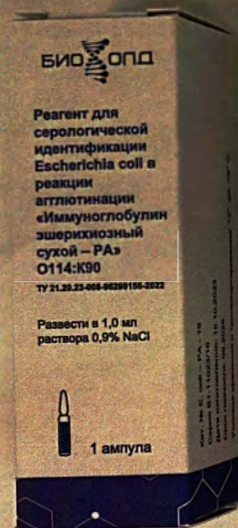

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O114:K90
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 16
РУ № _____

Серия В1- 10617/16

Дата изготовления _____

Наименование	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Иммуноглобулин сухой -РА O114:K90	
2. Технические характеристики	
Растворимость Иммуноглобулина сухого – РА не бо	
Показатель опти	
Иммуноглобулина сухого – РА при 0,9 % р-ра NaCl п	
нм, ед. опт. пл., в 1	
Микробиологичес	
Иммуноглобулина	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °C.

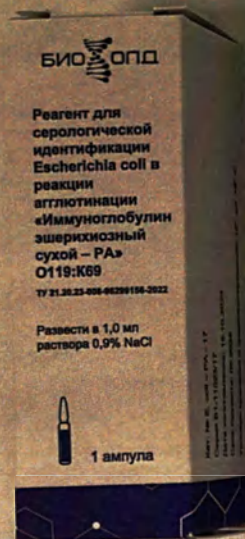

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O119:K69
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 17
РУ № _____

Серия В1- 10617/17
Дата изготовления _____

Наименование	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Иммуноглобулин сухой - РА O119	
2. Технические характеристики	
Растворимость	
Иммуноглобулин сухого – РА не б	
Показатель от	
Иммуноглобулин сухого – РА пр	
0,9 % р-ра NaCl	
нм, ед. опт. пл.,	
Микробиологич	
Иммуноглобулин	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

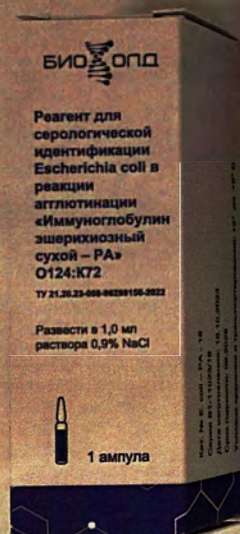

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O124:K72
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 18
РУ № _____

Серия В1- 10617/18
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O124:K72
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина сухого – РА при разведении 0,9 % р-ра NaCl при 490 нм, ед. опт. пл., в 1 мл
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина эшерихиозного



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

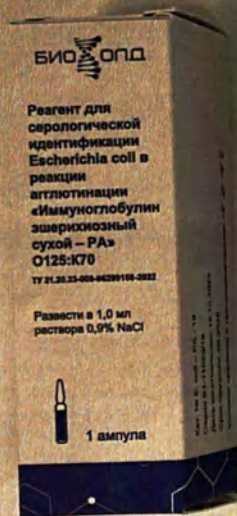

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O125:K70
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 19
РУ № _____

Серия В1- 10617/19
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O125:K70
2.Технические харак
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не более
Показатель оптиче
Иммуноглобулина
сухого – РА при раз
0,9 % р-ра NaCl при
нм, ед. опт. пл., в диа
Микробиологическая
Иммуноглобулина эш



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты
контроля

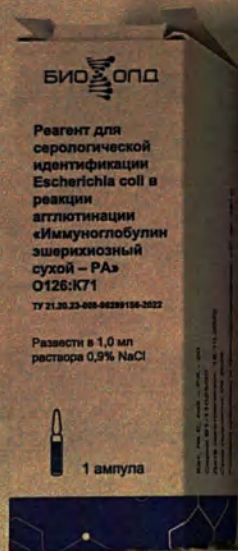

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O126:K71
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № *E. coli* – РА - 20
РУ № _____

Серия В1- 10617/20
Дата изготовления _____

Наименование	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Иммуноглобулин сухой -РА O126:K71	
2. Технические характеристики	
Растворимость Иммуноглобулина сухого – РА не более	
Показатель оптической плотности Иммуноглобулина сухого – РА при р-ре 0,9 % р-ра NaCl при 25 °С, ед. опт. пл., в д.м. Микробиологическая чистота Иммуноглобулина сухого – РА	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О- и К-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

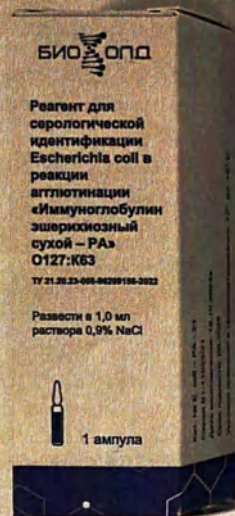

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O127:K63
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 21
РУ № _____

Серия В1- 10617/21
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O127:K63
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не бо
Показатель опти
Иммуноглобулина сухого – РА при 0,9 % р-ра NaCl п
нм, ед. опт. пл., в
Микробиологичес
Иммуноглобулин



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °C.

Результаты
контроля

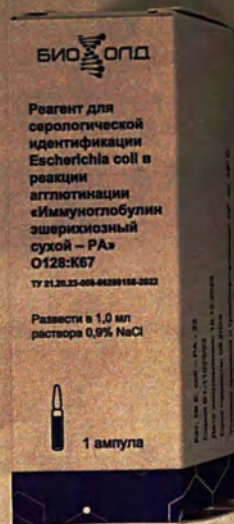

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O128:K67
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 22
РУ № _____

Серия В1- 10617/22
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O128:K67
2.Технические харак
Растворимость
Иммуноглобулина сухого – РА не более
Показатель оптиче
Иммуноглобулина сухого – РА при раз
0,9 % р-ра NaCl при
нм, ед. опт. пл., в диа
Микробиологическая
Иммуноглобулина эш



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

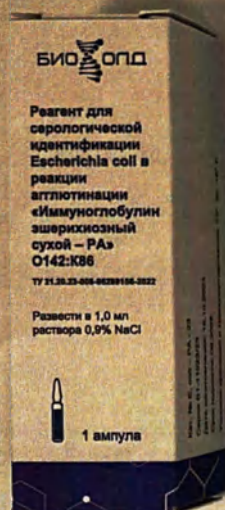

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O142:K86
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 23
РУ № _____

Серия В1- 10617/23
Дата изготовления _____

Наименование	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Иммуноглобулин сухой -РА O142:K86	
2. Технические характеристики	
Растворимость Иммуноглобулина сухого – РА не более	
Показатель оптической плотности Иммуноглобулина сухого – РА при разв. 0,9 % р-ра NaCl при 220 нм, ед. опт. пл., в д.л.	
Микробиологическая чистота Иммуноглобулина э	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K59; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

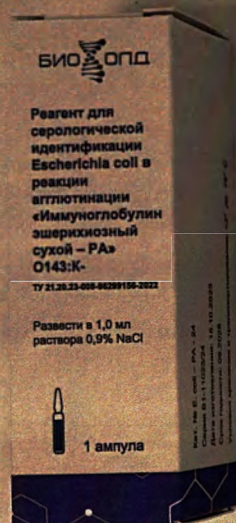

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O143:K-
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 24
РУ № _____

Серия В1- 10617/24

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой - РА O143:K
2. Технические ха
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не бол
Показатель опти
Иммуноглобулина
сухого – РА при 1
0,9 % р-ра NaCl п
нм, ед. опт. пл., в д
Микробиологичес
Иммуноглобулина



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia
coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °C.

Результаты контроля

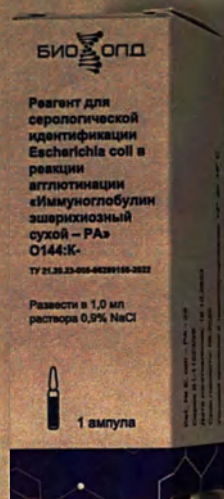

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O144:K-
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 25
РУ № _____

Серия В1- 10617/25
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O144:K-
2. Технические харак
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не более
Показатель оптиче
Иммуноглобулина
сухого – РА при раз
0,9 % р-ра NaCl при
нм, ед. опт. пл., в диа
Микробиологическая




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.
1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.
Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

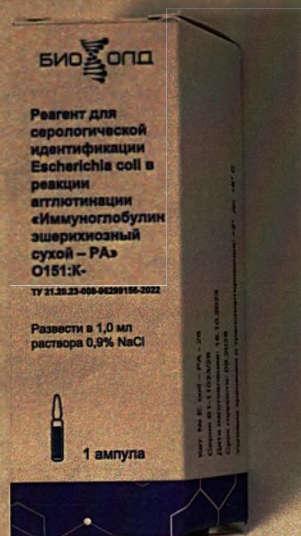

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» O151:K-
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli - РА - 26
РУ № _____

Серия В1- 10617/26
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой - РА O151:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина сухого - РА не более
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина сухого - РА при разв. в 0,9 % р-ра NaCl при 25 °С, в д.л.
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина эшерихиозного - РА не более



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой - РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Результаты контроля

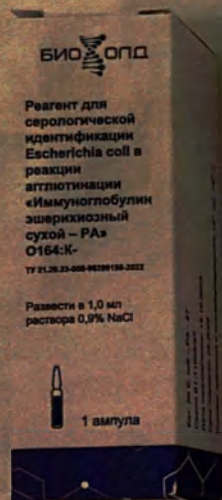

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» O164:K-
по ТУ 20.21.23-008-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 27
РУ № _____

Серия В1- 10617/27
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Иммуноглобулин сухой -РА O164:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Иммуноглобулина
сухого – РА не более
Показатель оптической плотности
Иммуноглобулина
сухого – РА при разведении
0,9 % р-ра NaCl при 540 нм, ед. опт. пл., в диаметре 1 см
Микробиологическая чистота
Иммуноглобулина эшерихиозного



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой предназначен для выявления следующих антигенов: O1:K1; O6:K15; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O32:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O112ab:K68; O112ac:K66; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 °С.

Прошито, пронумеровано
(28 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

Прошито, пронумеровано
(28 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор ООО
«БиоХолд»

И.В. Радешкин

A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the printed name of the director.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

« » МОСКВА 2024 г.

**ПРОЕКТ МАКЕТА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО,
УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O1:K1**

Кат. № E.coli – РА – 1

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O6:K15 (кат. № E. coli – РА - 2) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО,
УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O6:K15**

Кат. № E.coli – РА – 2

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O6:K15 (кат. № E. coli – РА - 2) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O20:K84**

Кат. № E.coli – РА – 3
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O20:K84 (кат. № E. coli – РА - 3) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O25:K11**

Кат. № E.coli – РА – 4
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O25:K11 (кат. № E. coli – РА - 4) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O26:K60**

Кат. № E.coli – РА – 5

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O26:K60 (кат. № E. coli – РА - 5) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O28:K73**

Кат. № E.coli – РА – 6

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O28:K73 (кат. № E. coli – РА - 6) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O32:K-**

Кат. № E.coli – РА – 7
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O32:K- (кат. № E. coli – РА - 7) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O44:K74**

Кат. № E.coli – РА – 8
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O44:K74 (кат. № E. coli – РА - 8) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O55:K59**

Кат. № E.coli – РА – 9
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O55:K59 (кат. № E. coli – РА - 9) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O75:K95**

Кат. № E.coli – РА – 10
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O75:K95 (кат. № E. coli – РА - 10) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O85:K-**

Кат. № E.coli – РА – 11
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O85:K- (кат. № E. coli – РА - 11) 1,0 мл
- 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O86:K61**

Кат. № E.coli – РА – 12
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O86:K61 (кат. № E. coli – РА - 12) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O111:K58**

Кат. № E.coli – РА – 13

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O111:K58 (кат. № E. coli – РА - 13) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O112:K66**

Кат. № E.coli – РА – 14

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O112:K66 (кат. № E. coli – РА - 14) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O112:K68**

Кат. № E.coli – РА – 15
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O112:K68 (кат. № E. coli – РА - 15) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O114:K90**

Кат. № E.coli – РА – 16
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O114:K90 (кат. № E. coli – РА - 16) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O119:K69**

Кат. № E.coli – РА – 17

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O119:K69 (кат. № E. coli – РА - 17) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O124:K72**

Кат. № E.coli – РА – 18

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O124:K72 (кат. № E. coli – РА - 18) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O125:K70**

Кат. № E.coli – РА – 19

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O125:K70 (кат. № E. coli – РА - 19) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O126:K71**

Кат. № E.coli – РА – 20

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O126:K71 (кат. № E. coli – РА - 20) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O127:K63**

Кат. № E.coli – РА – 21

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O127:K63 (кат. № E. coli – РА - 21) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O128:K67**

Кат. № E.coli – РА – 22

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O128:K67 (кат. № E. coli – РА - 22) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O142:K86**

Кат. № E.coli – РА – 23

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O142:K86 (кат. № E. coli – РА - 23) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O143:K-**

Кат. № E.coli – РА – 24

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O143:K- (кат. № E. coli – РА - 24) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O144:K-**

Кат. № E.coli – РА – 25
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O144:K- (кат. № E. coli – РА - 25) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O151:K-**

Кат. № E.coli – РА – 26
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O151:K- (кат. № E. coli – РА - 26) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА» по ТУ
21.20.23-008-96299156-2022
O164:K-**

Кат. № E.coli – РА – 27

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА O164:K- (кат. № E. coli – РА - 27) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

Прошито, пронумеровано
(15) лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.
«20» 03 2024 г.

**РАЗВЕРТКА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**


производитель:


Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия


(ООО «БиоХолд»)


Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

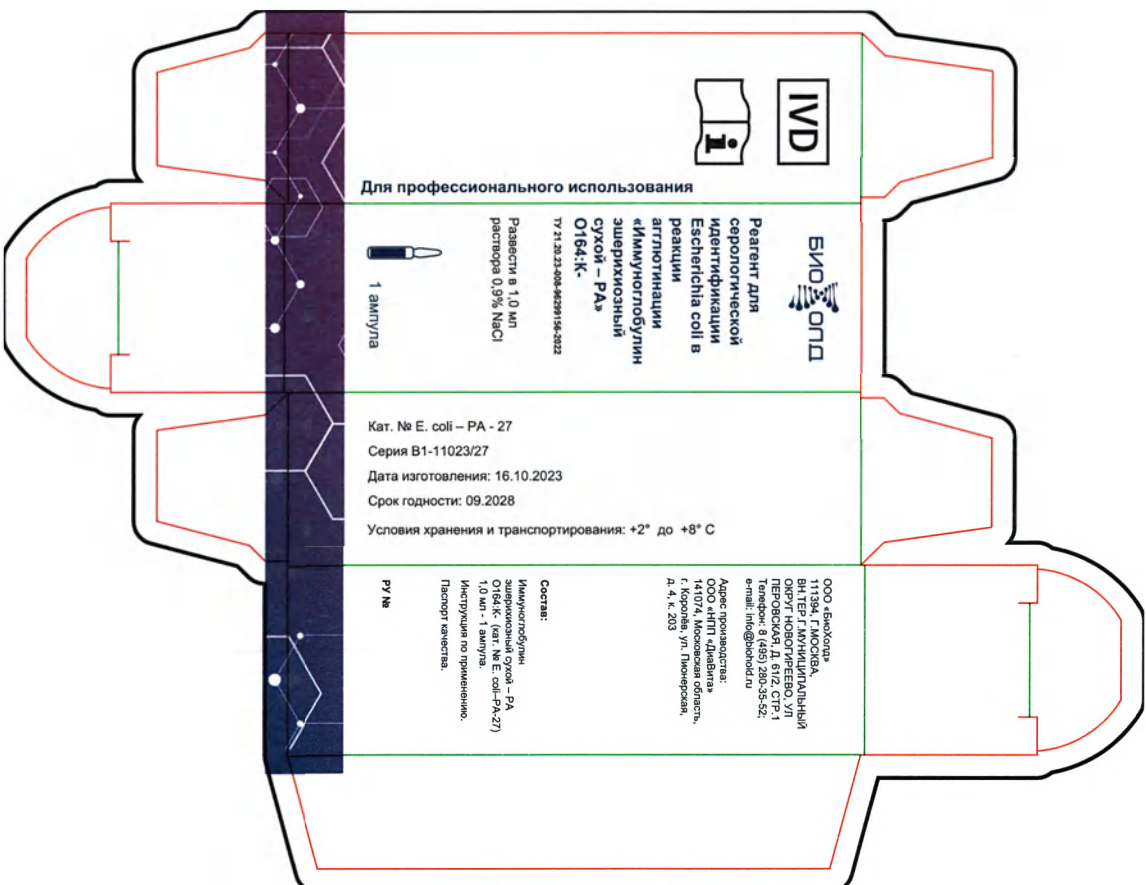


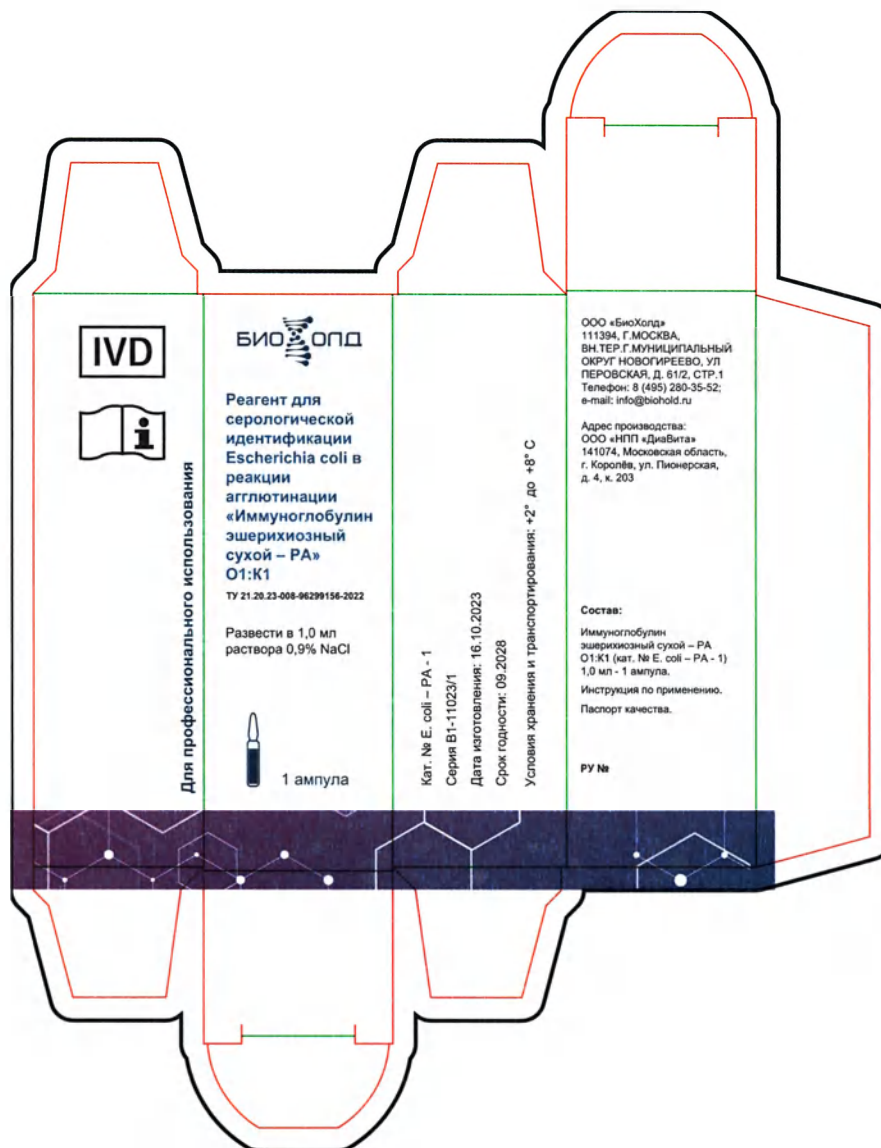


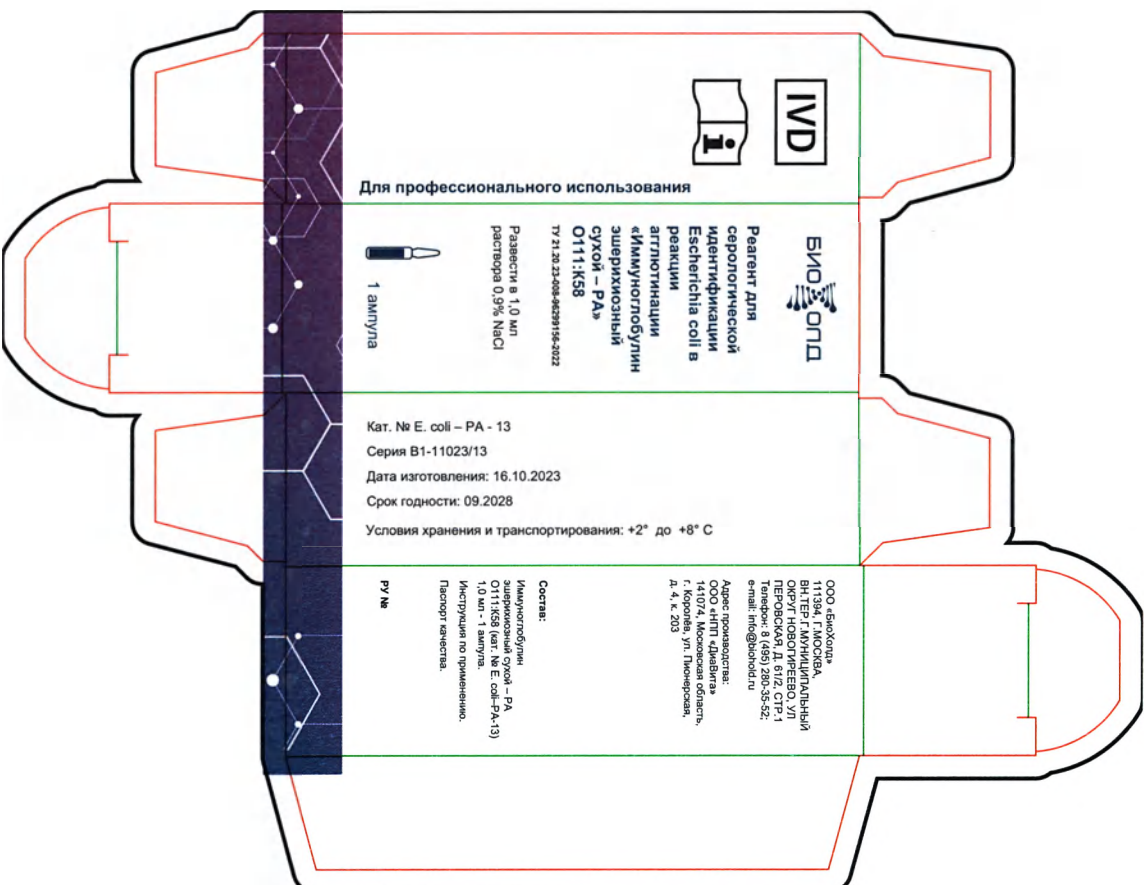


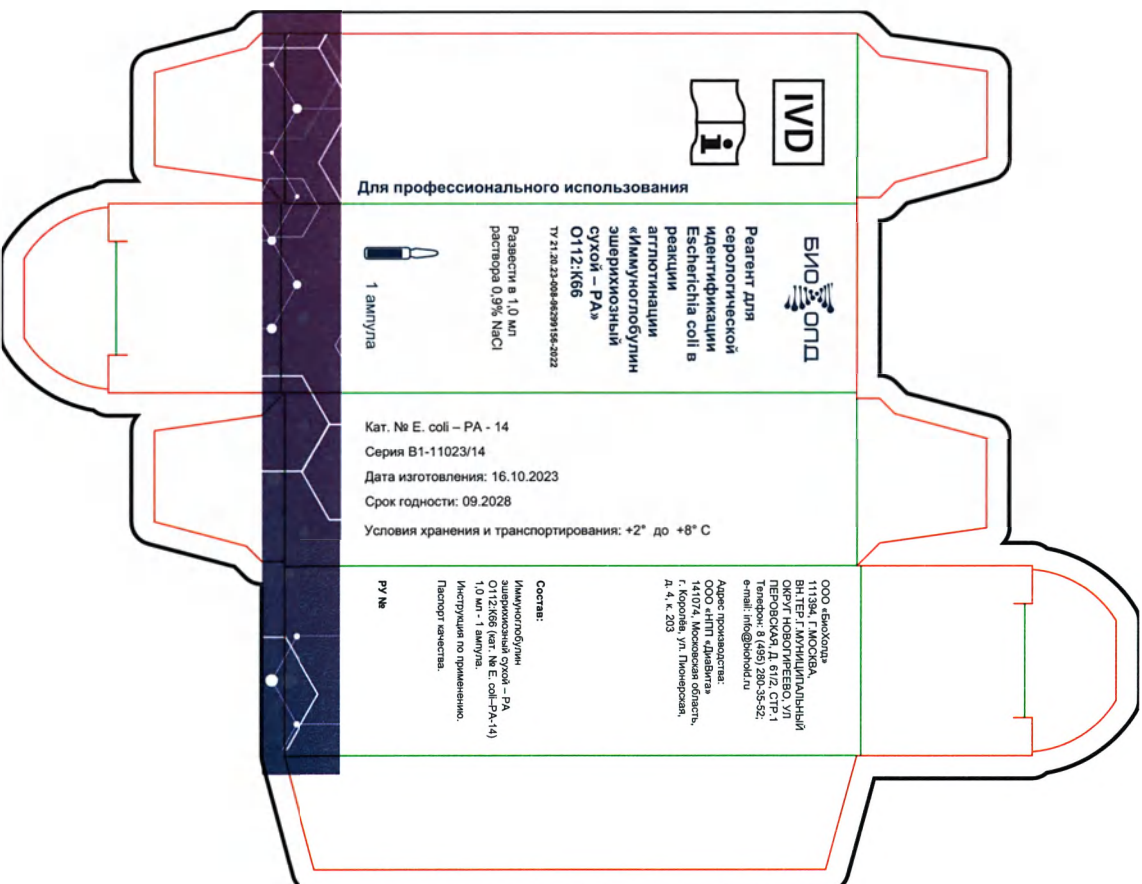


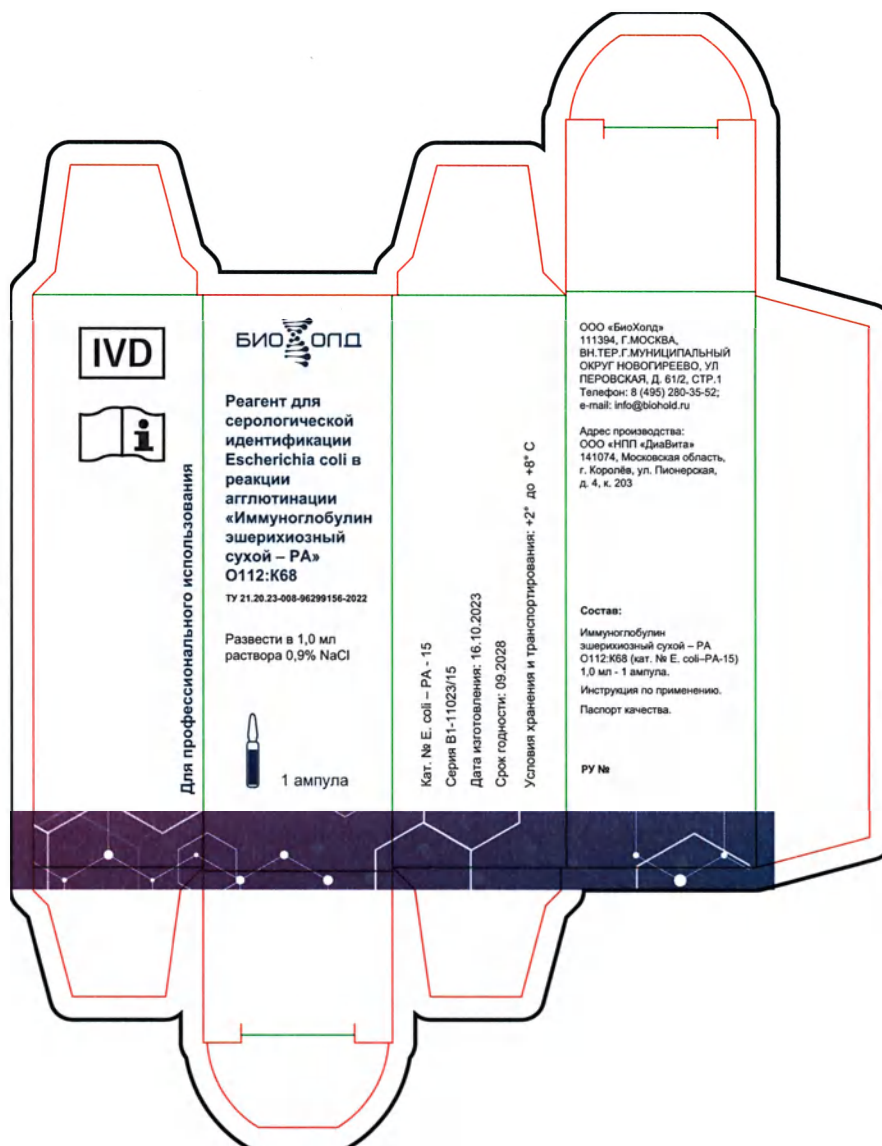


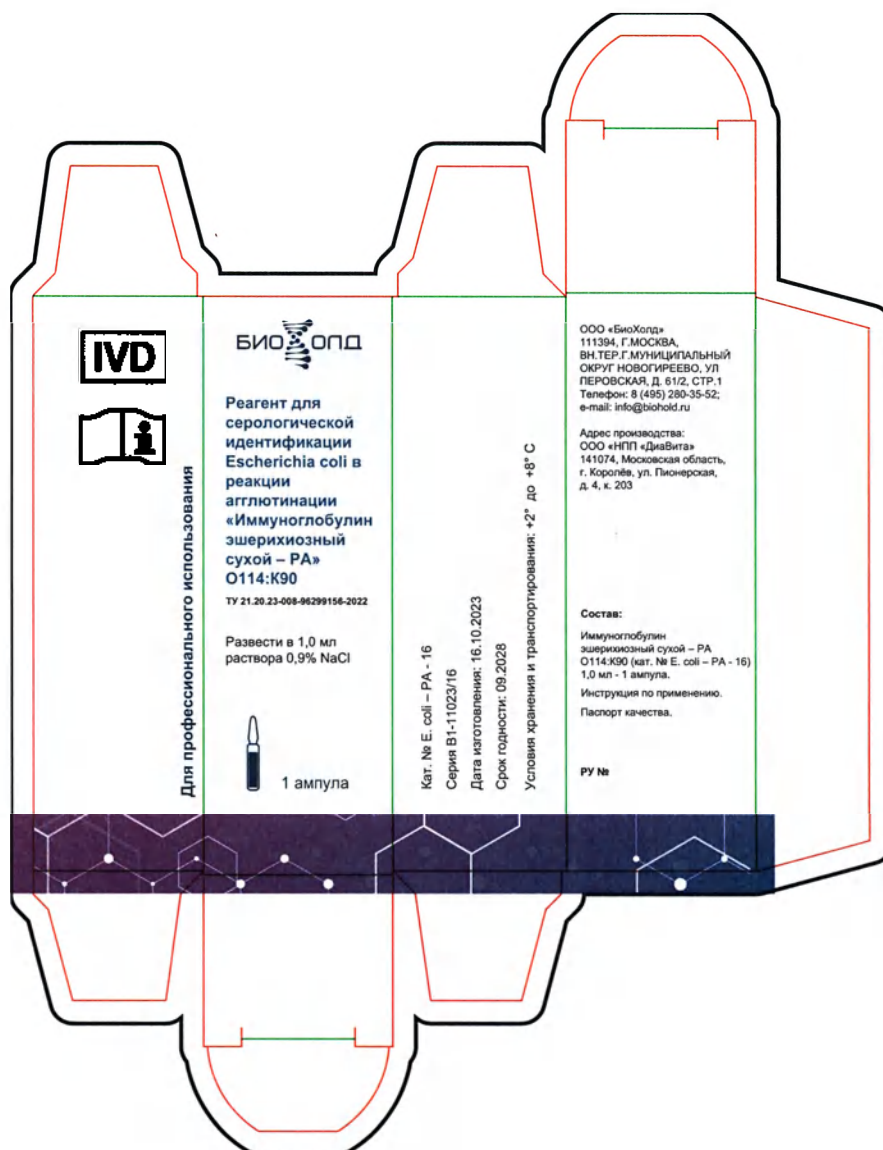


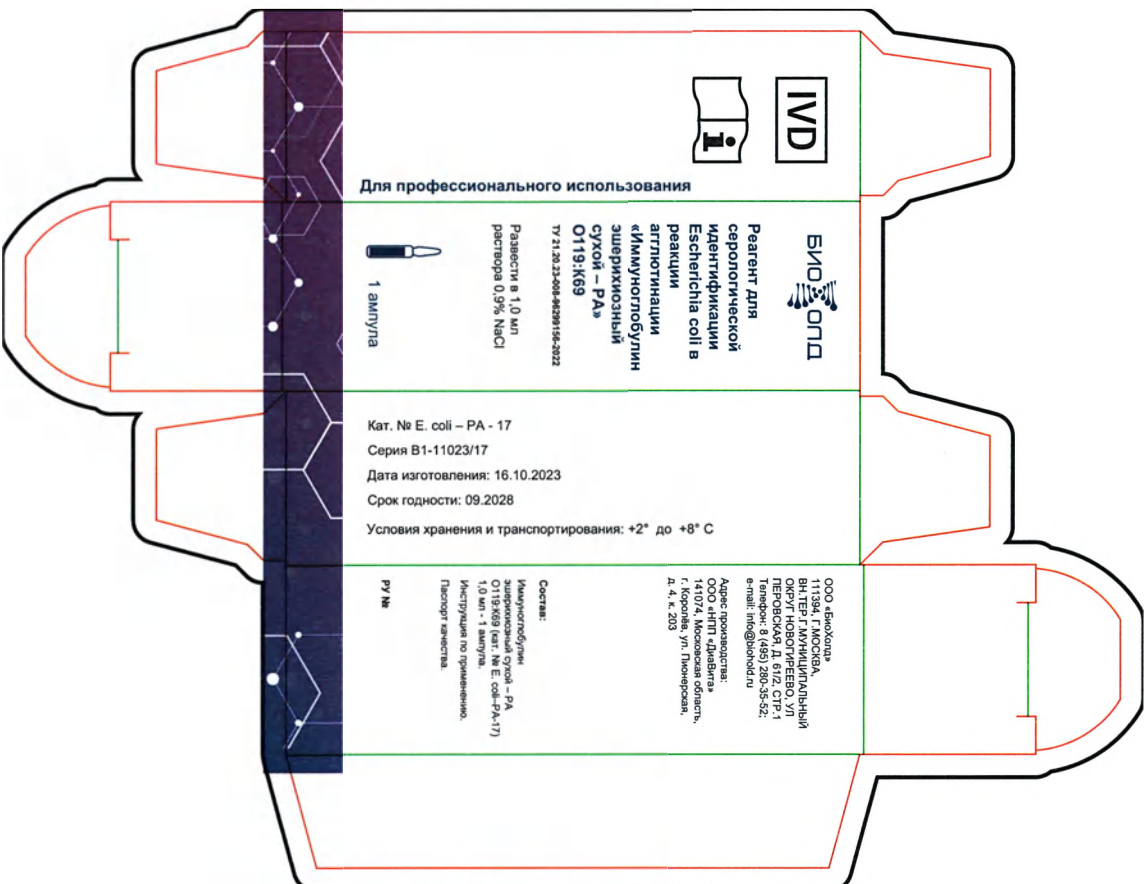


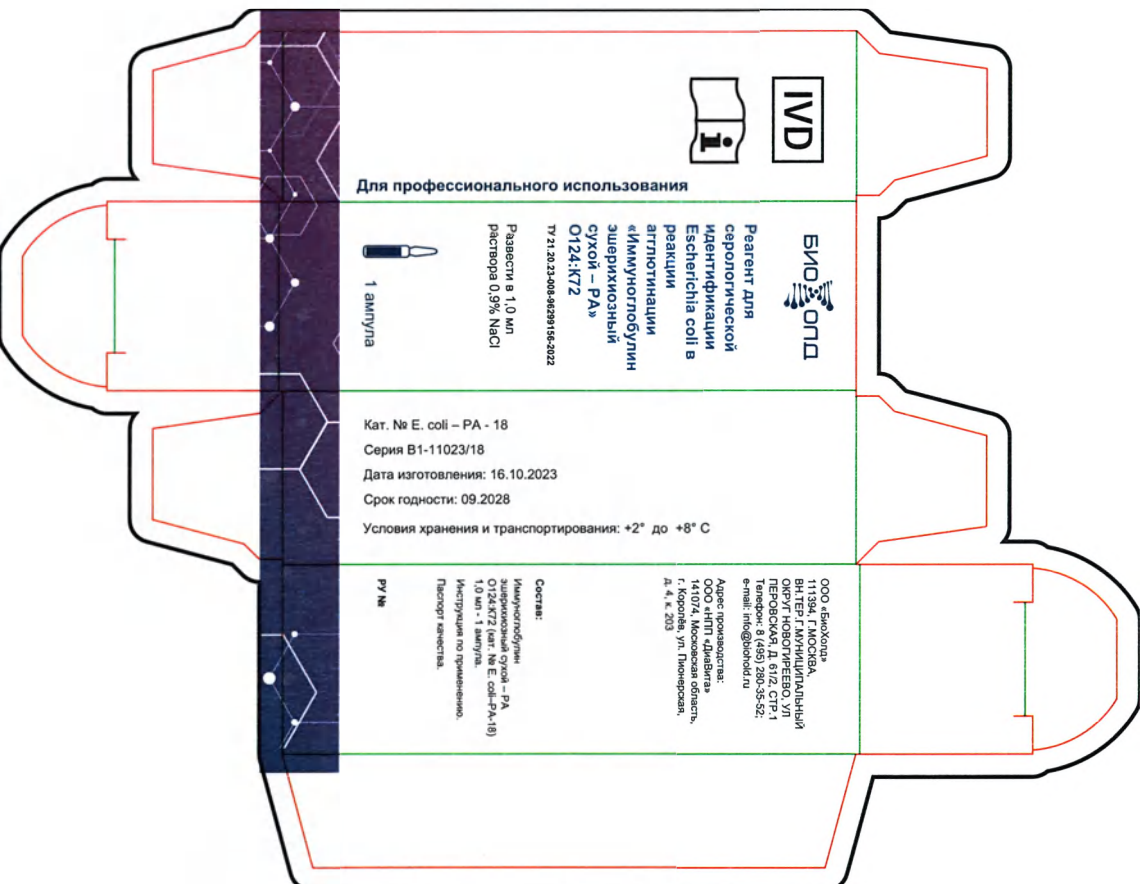


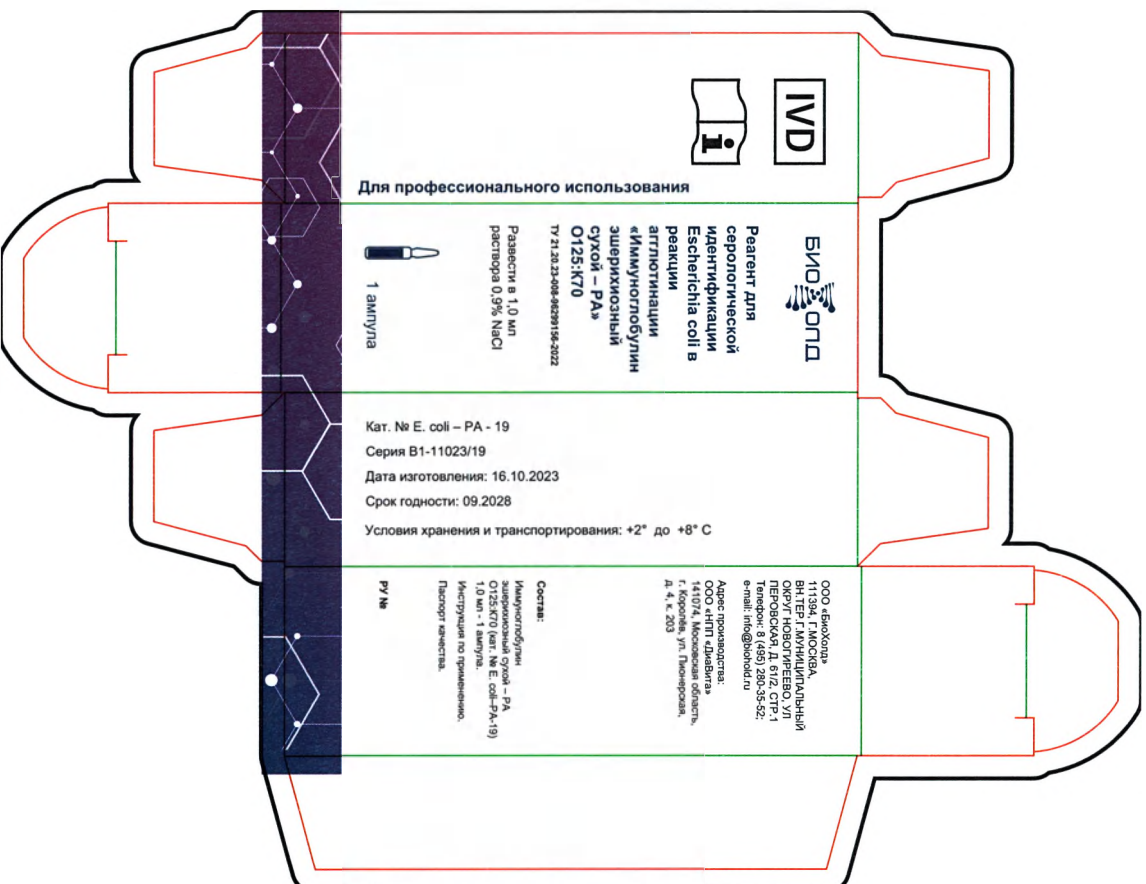


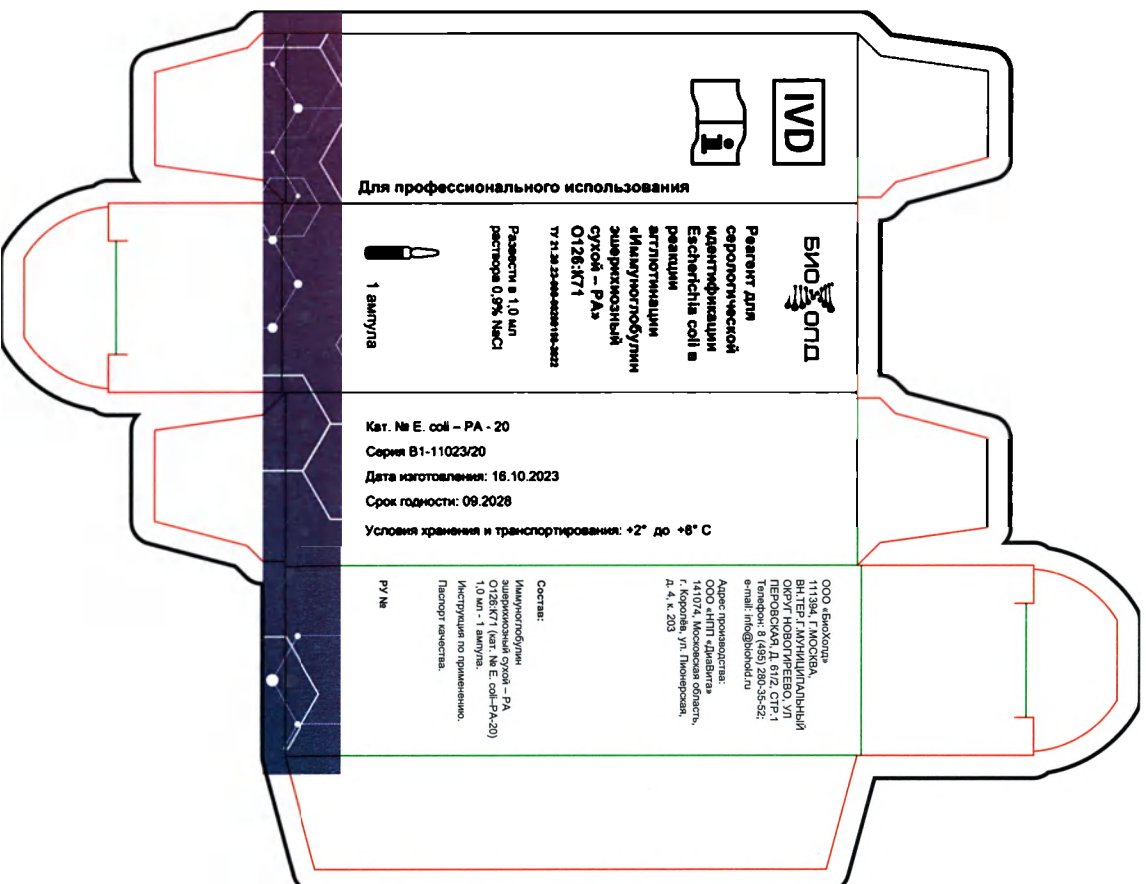


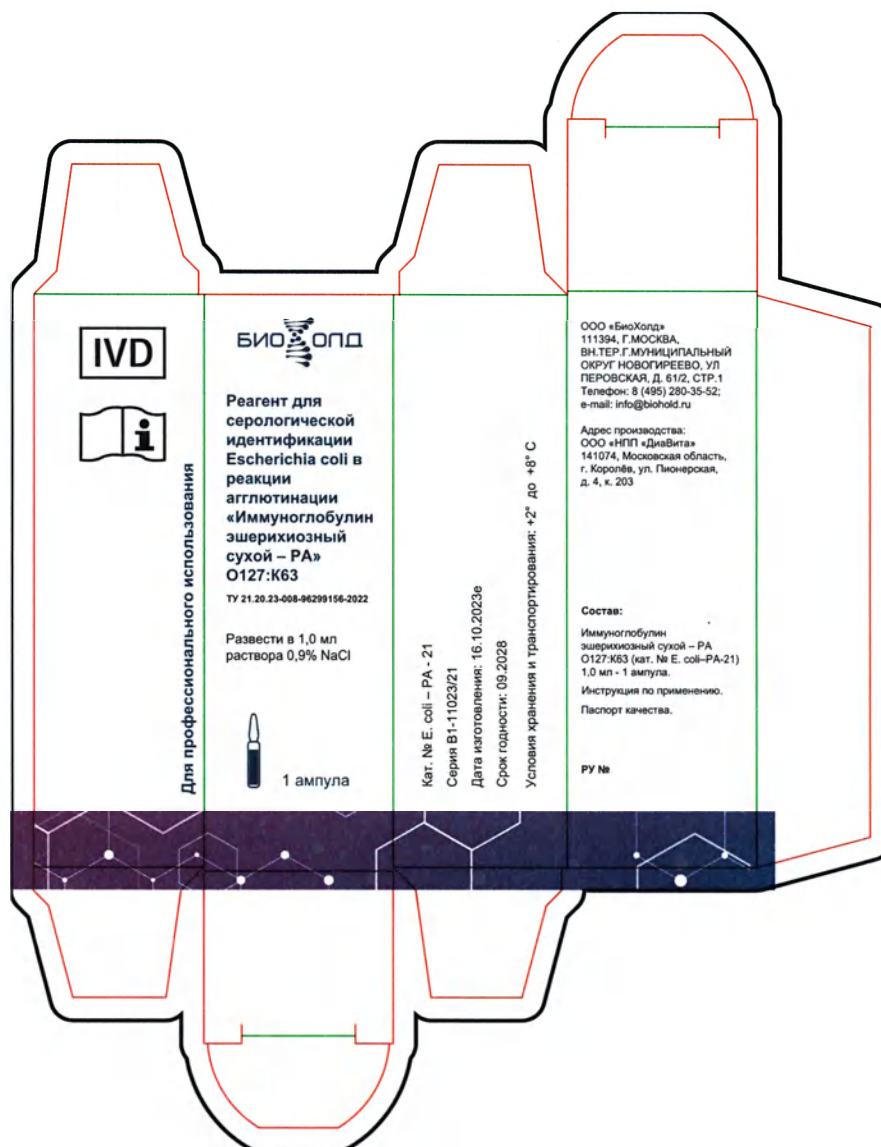


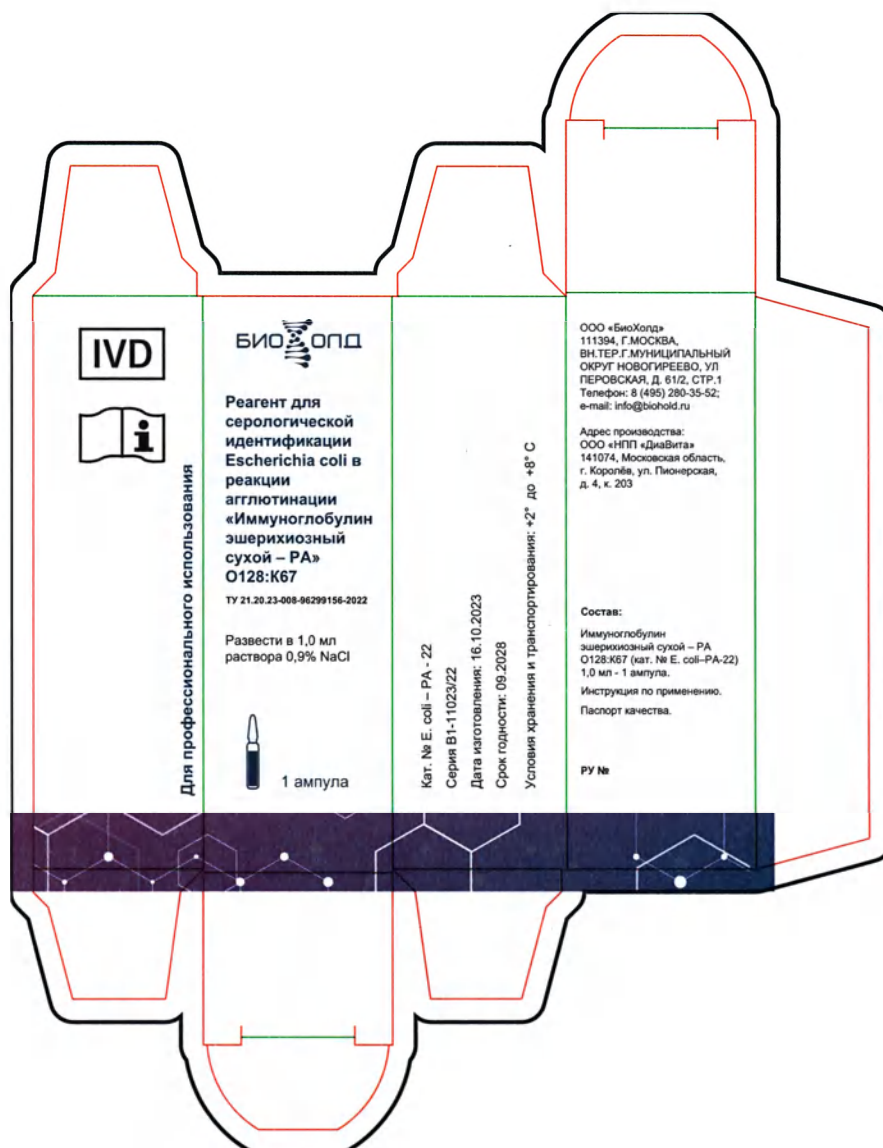


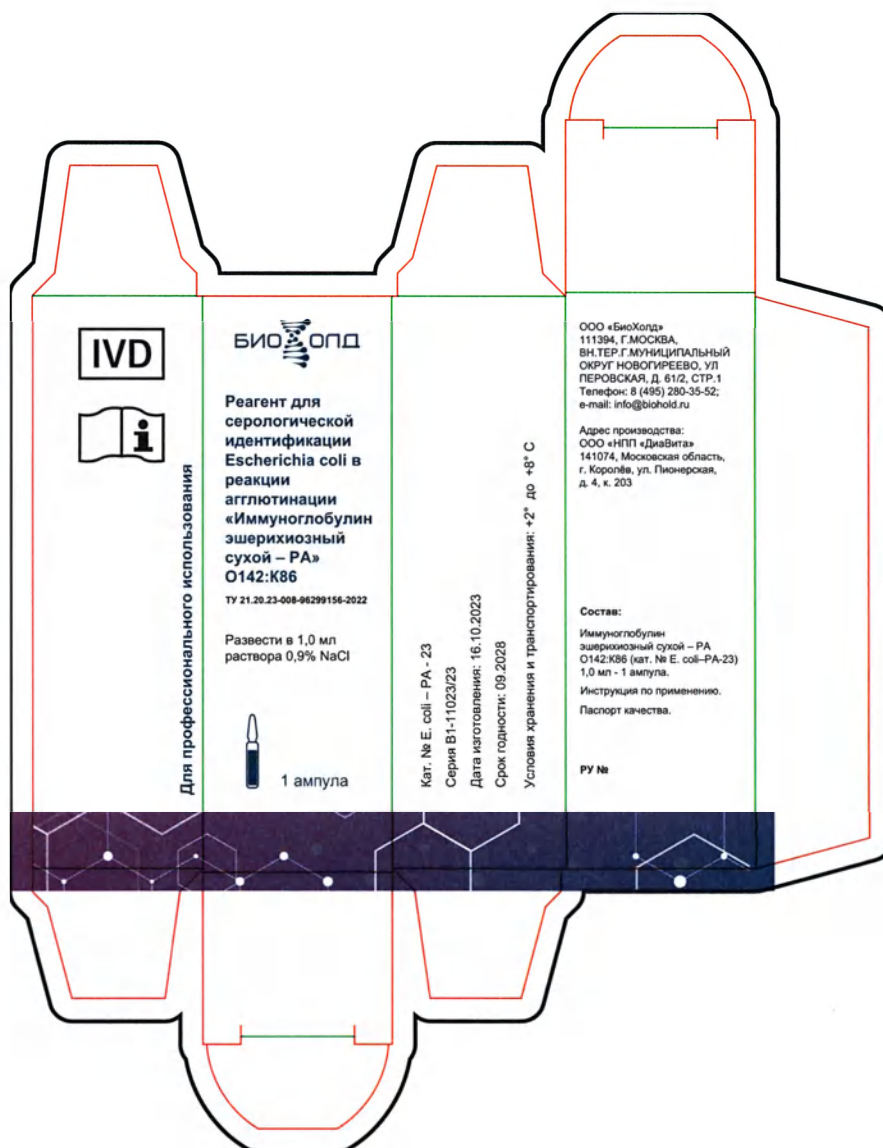


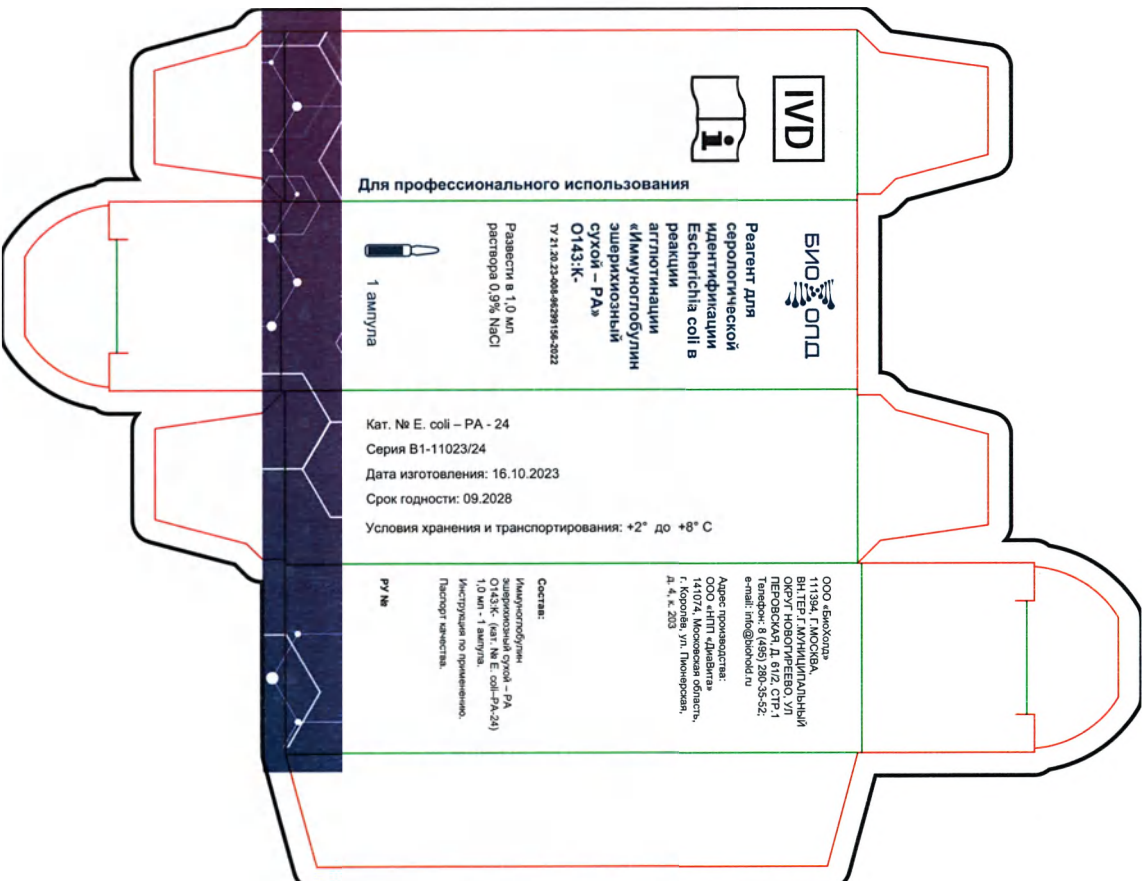


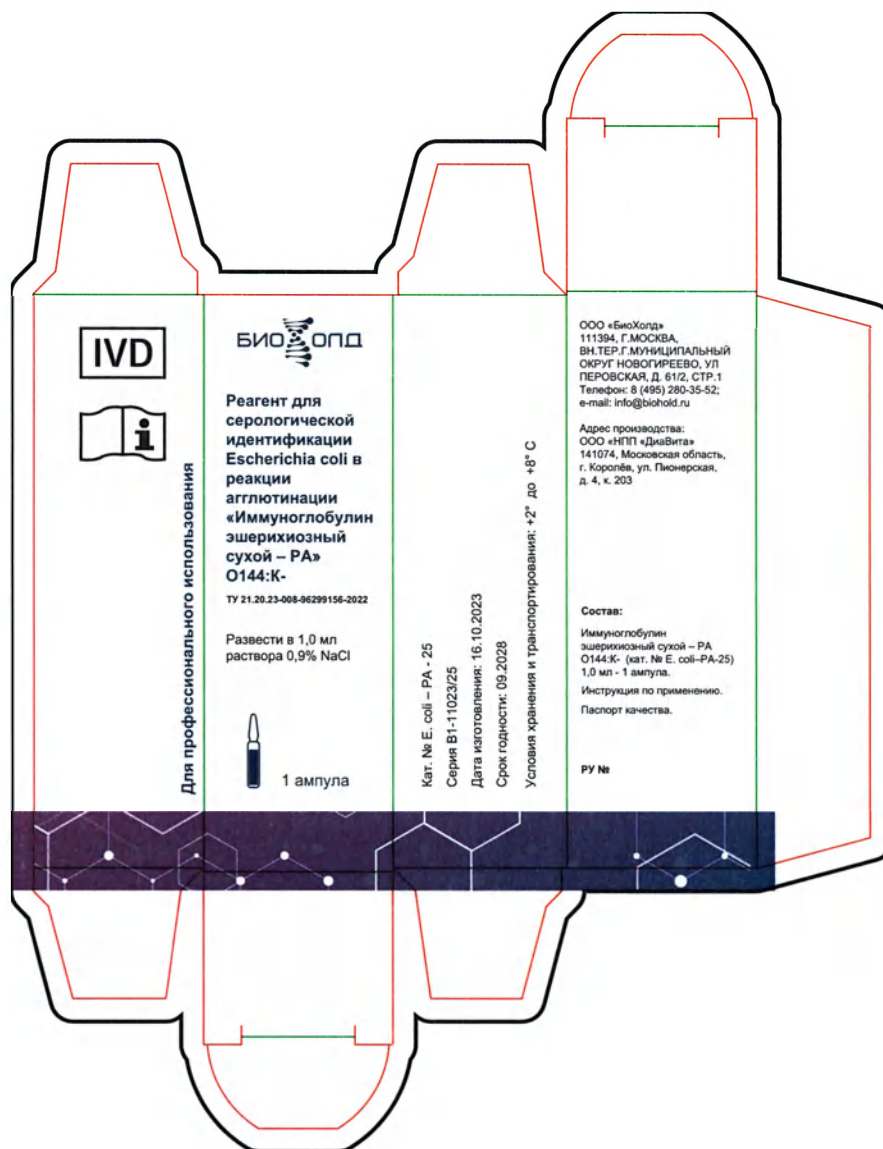


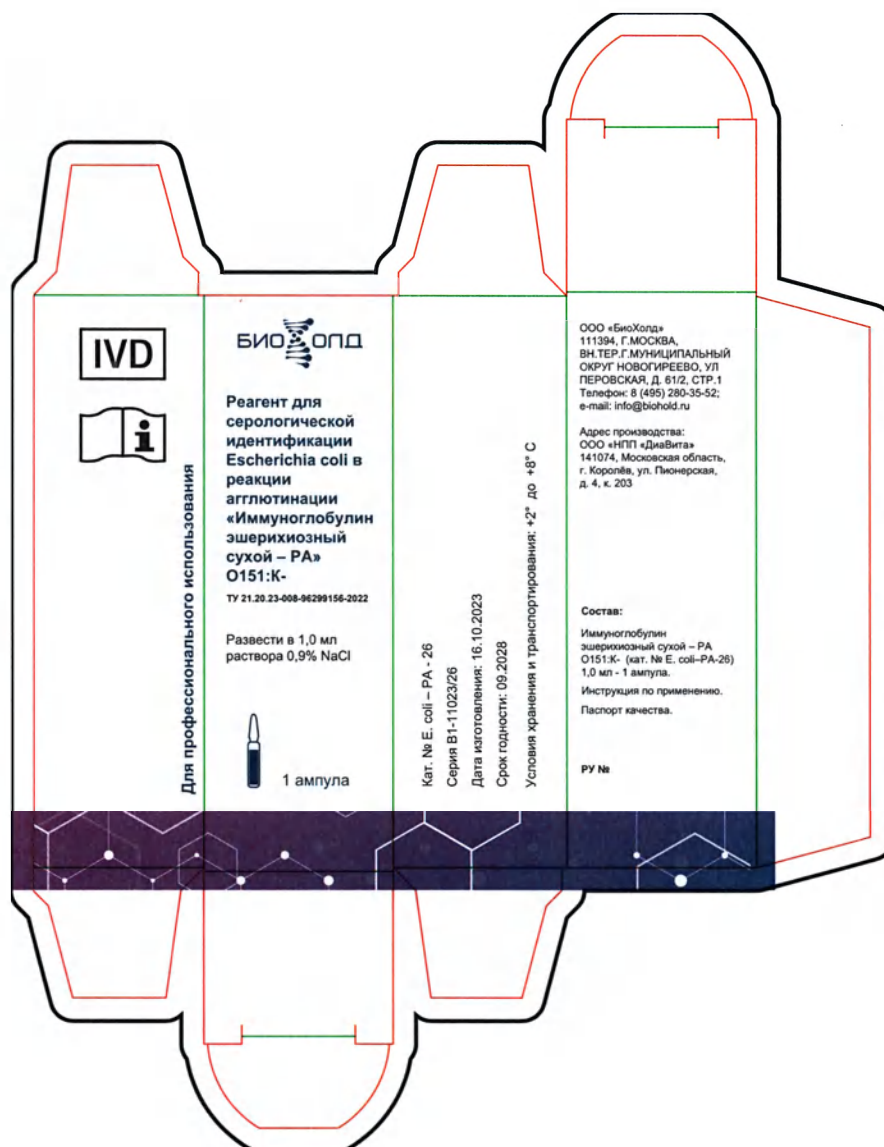

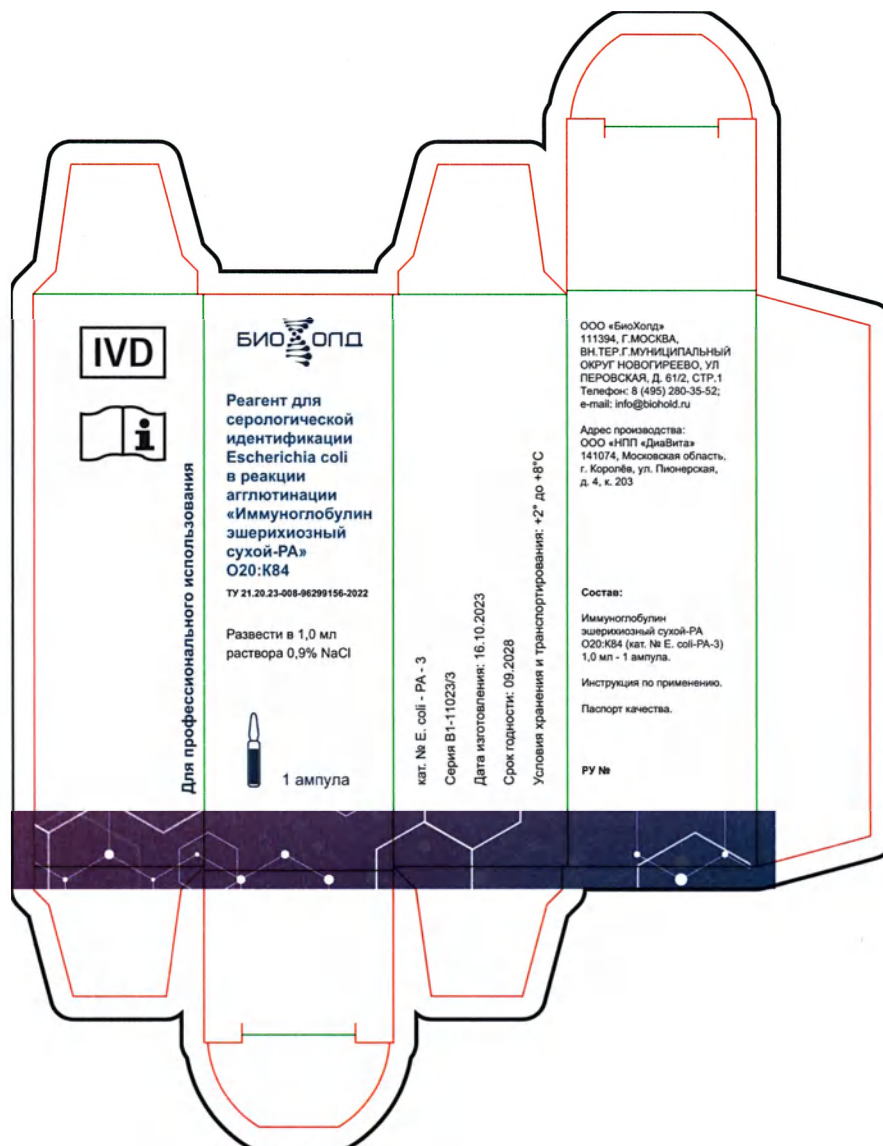

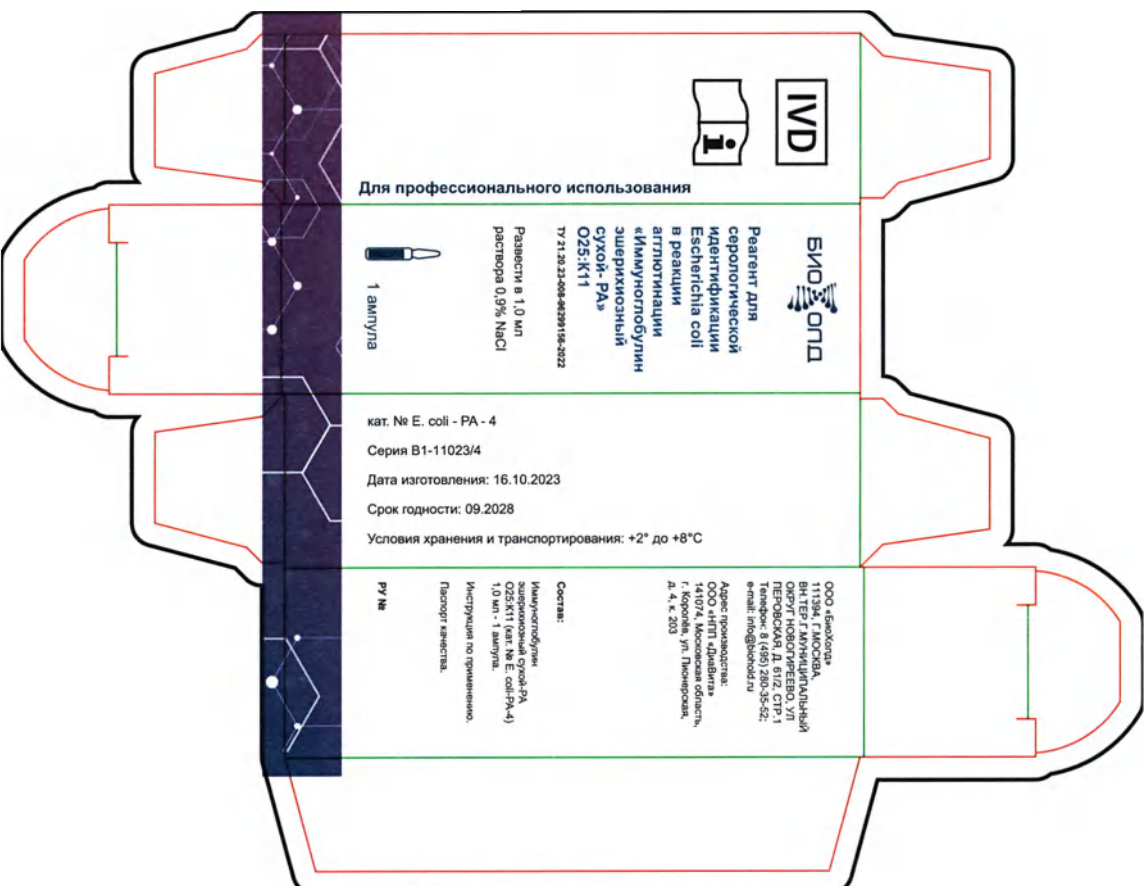

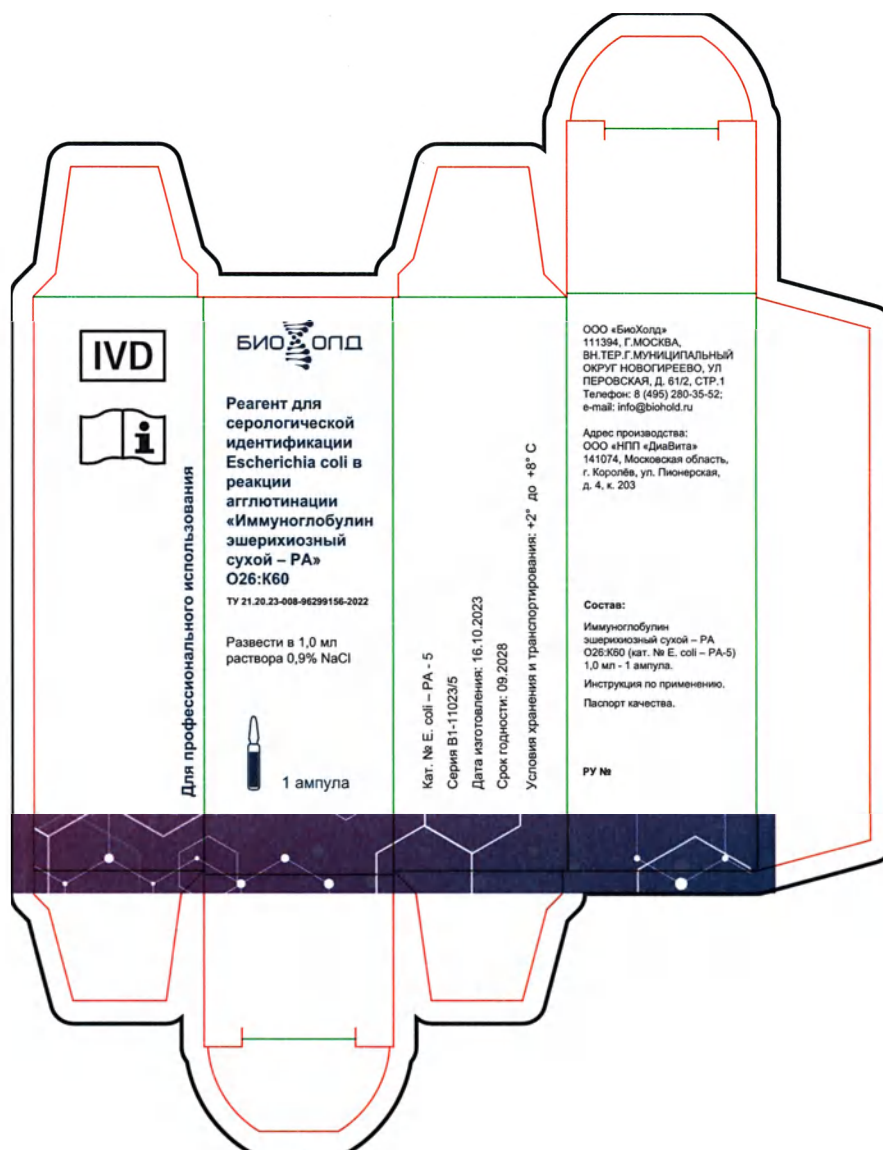

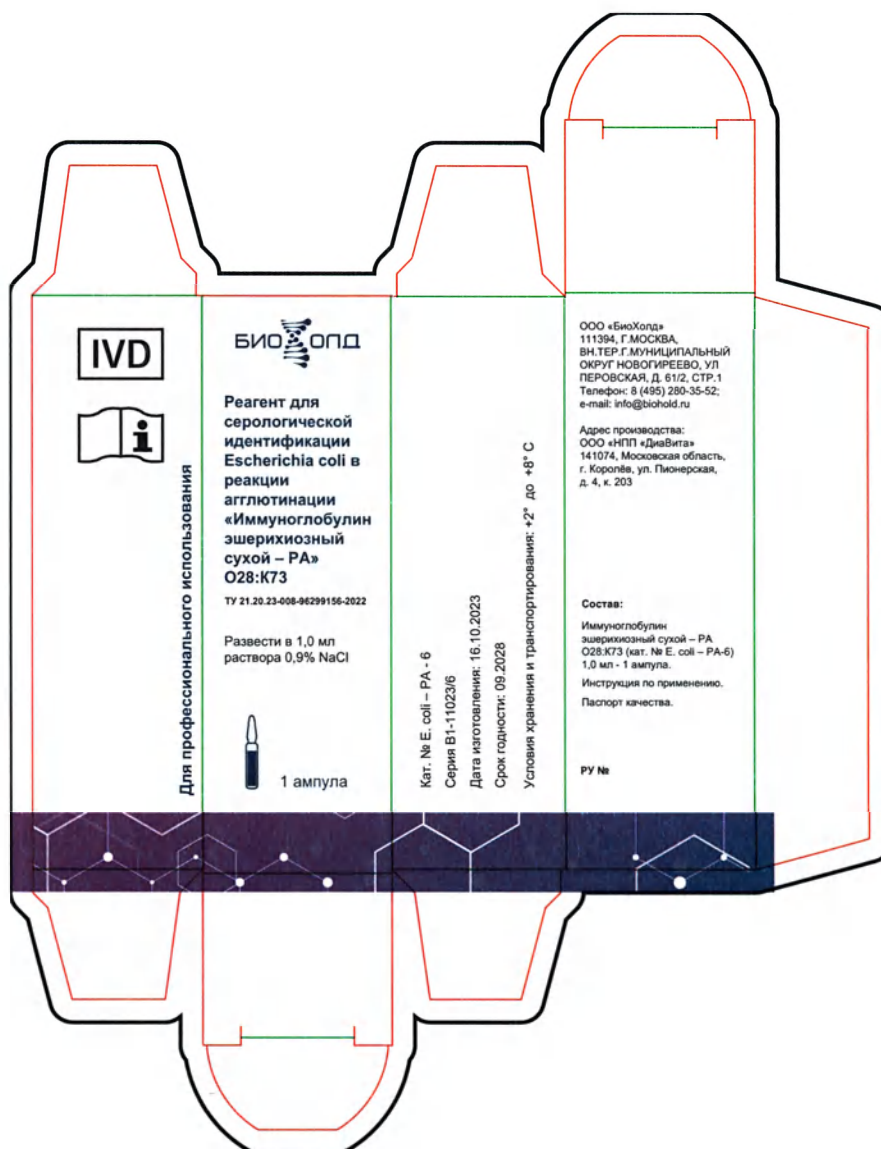

IVD



Для профессионального использования

БИОХОЛД

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Иммуноглобулин
эшерихиозный
сухой – РА»
O28:K73

ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула

Кат. № *E. coli* – РА - 6

Серия B1-110236

Дата изготовления: 16.10.2023

Срок годности: 09.2028

Условия хранения и транспортирования: +2° до +8° С

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА,
ВНТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королев, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203


Состав:


Иммуноглобулин
эшерихиозный сухой – РА
O28:K73 (кат. № *E. coli* – РА-6)
1,0 мл - 1 ампула.


Инструкция по применению.
Паспорт качества.


РУ №

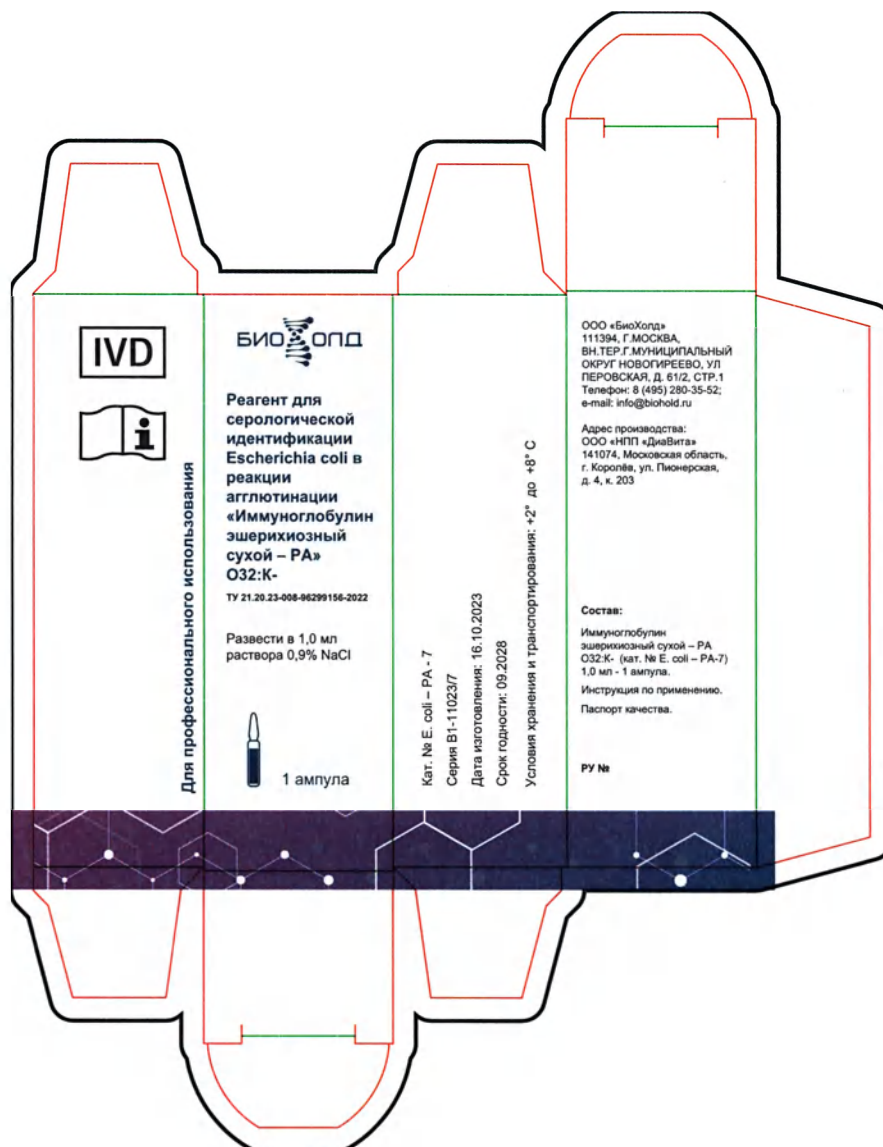


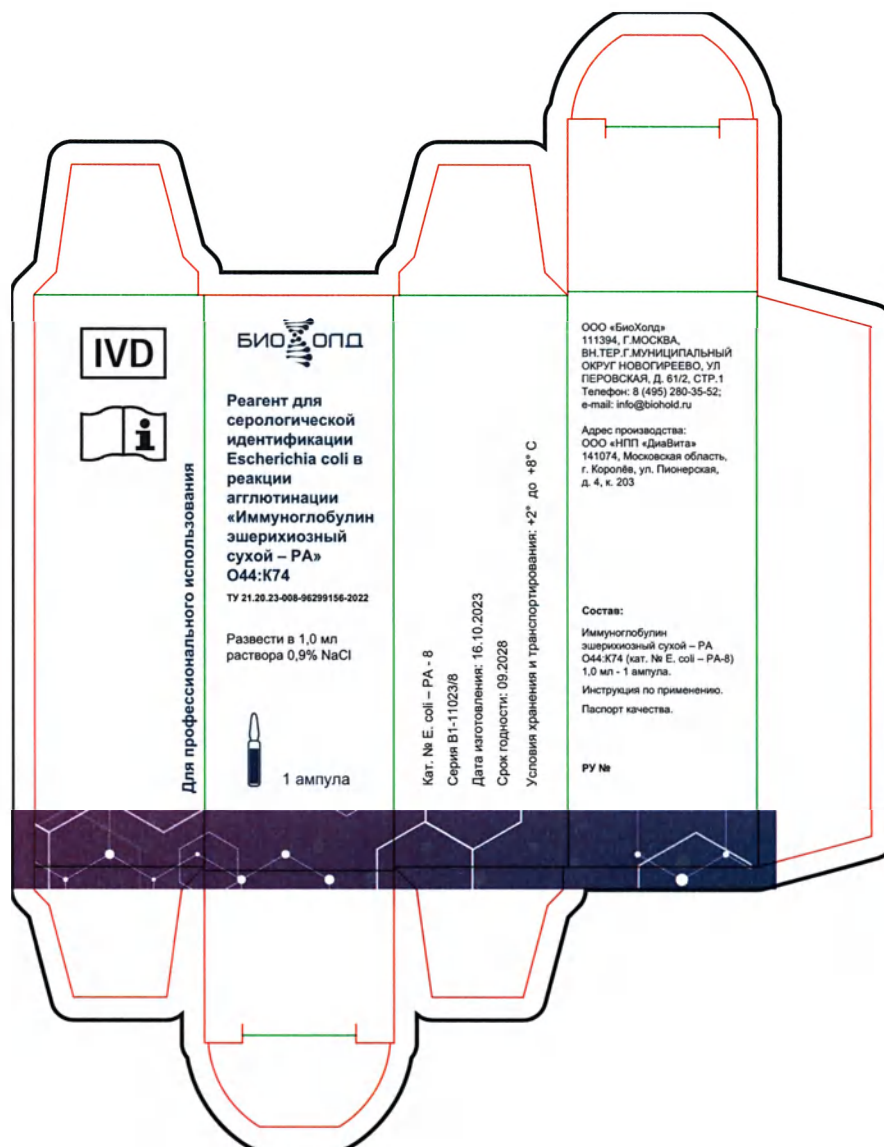


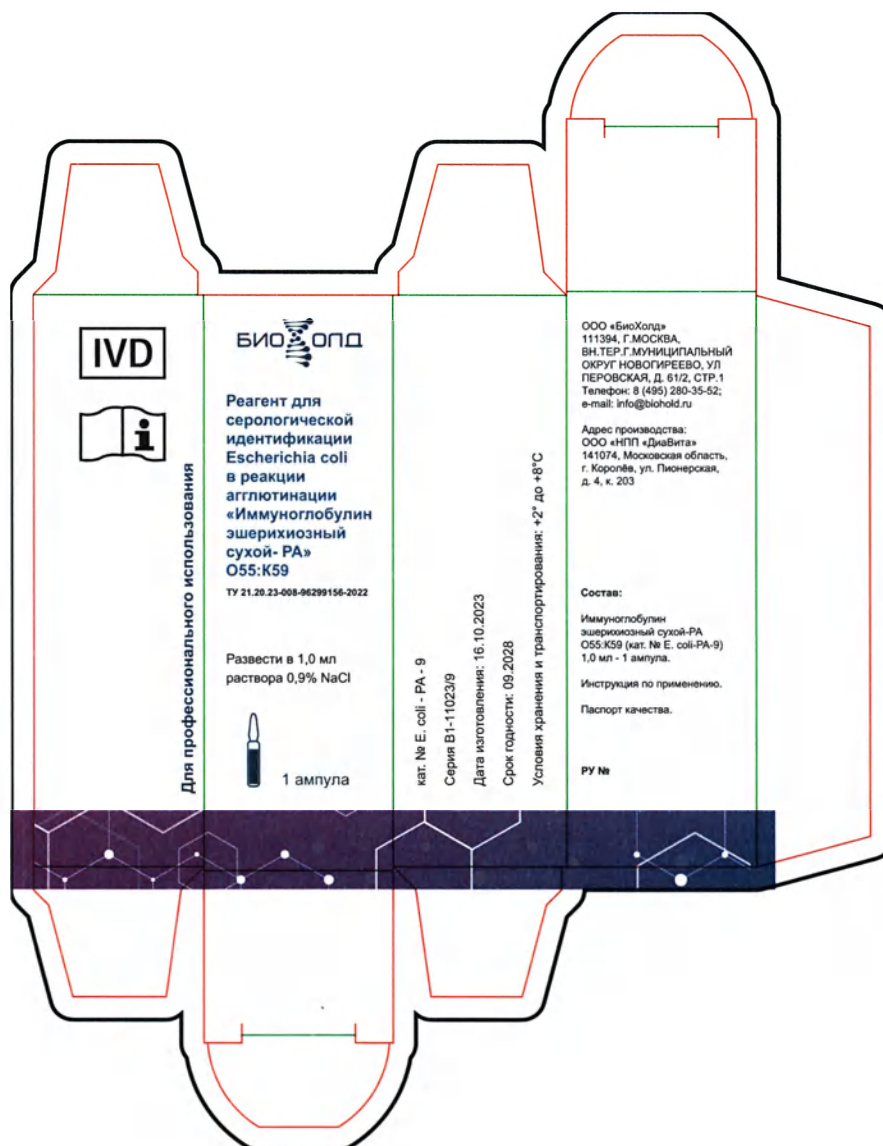

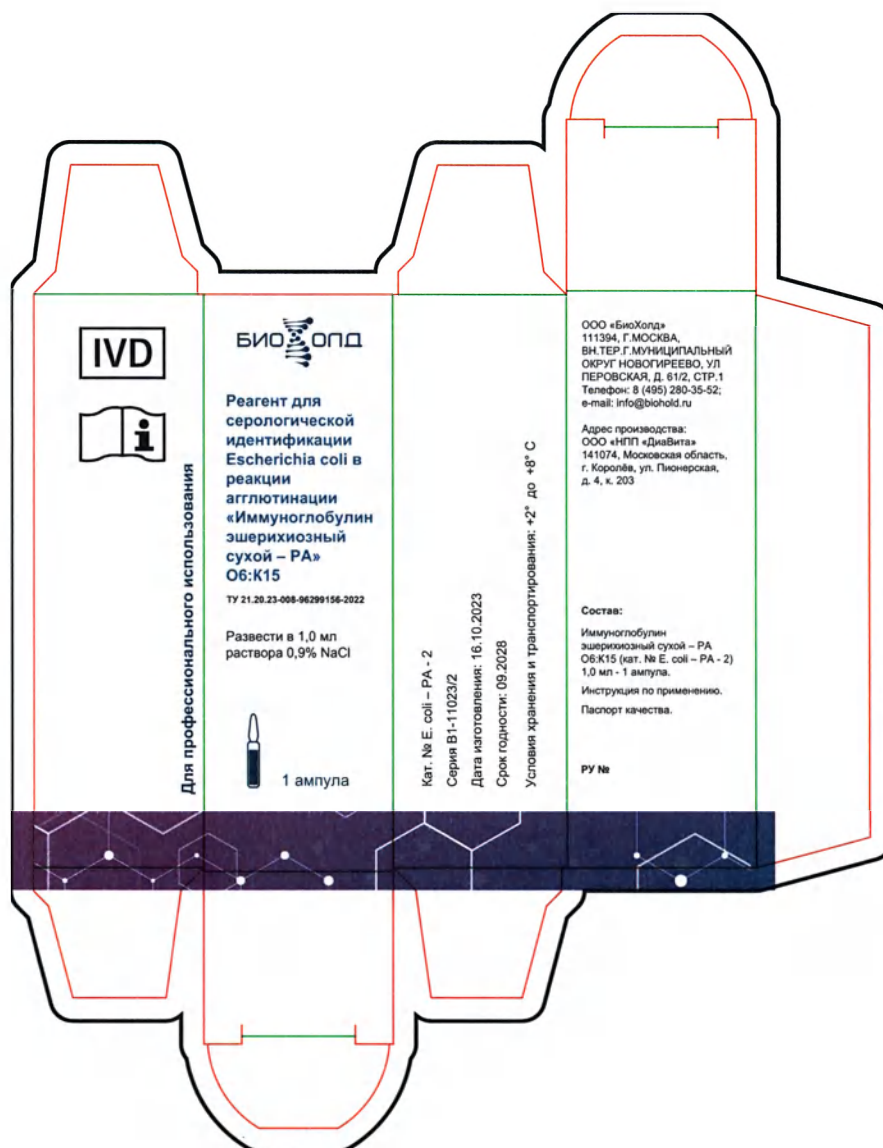

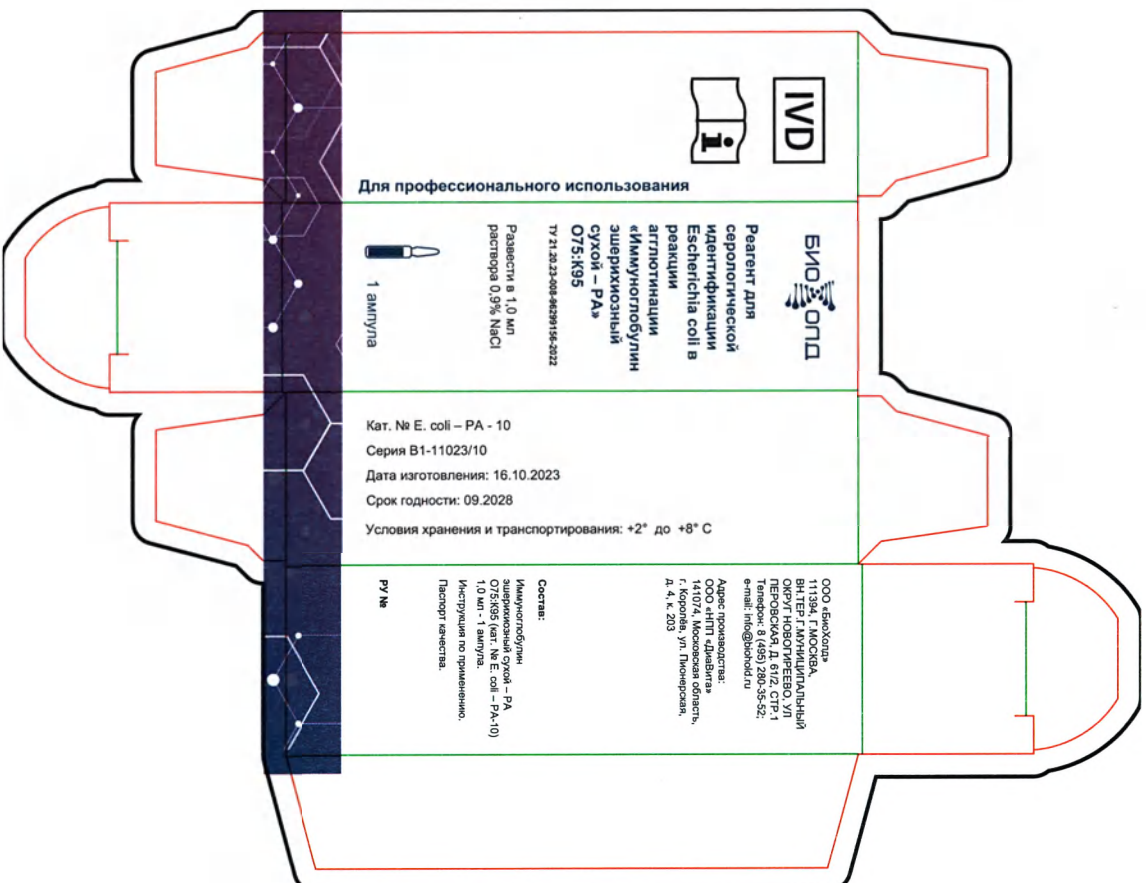

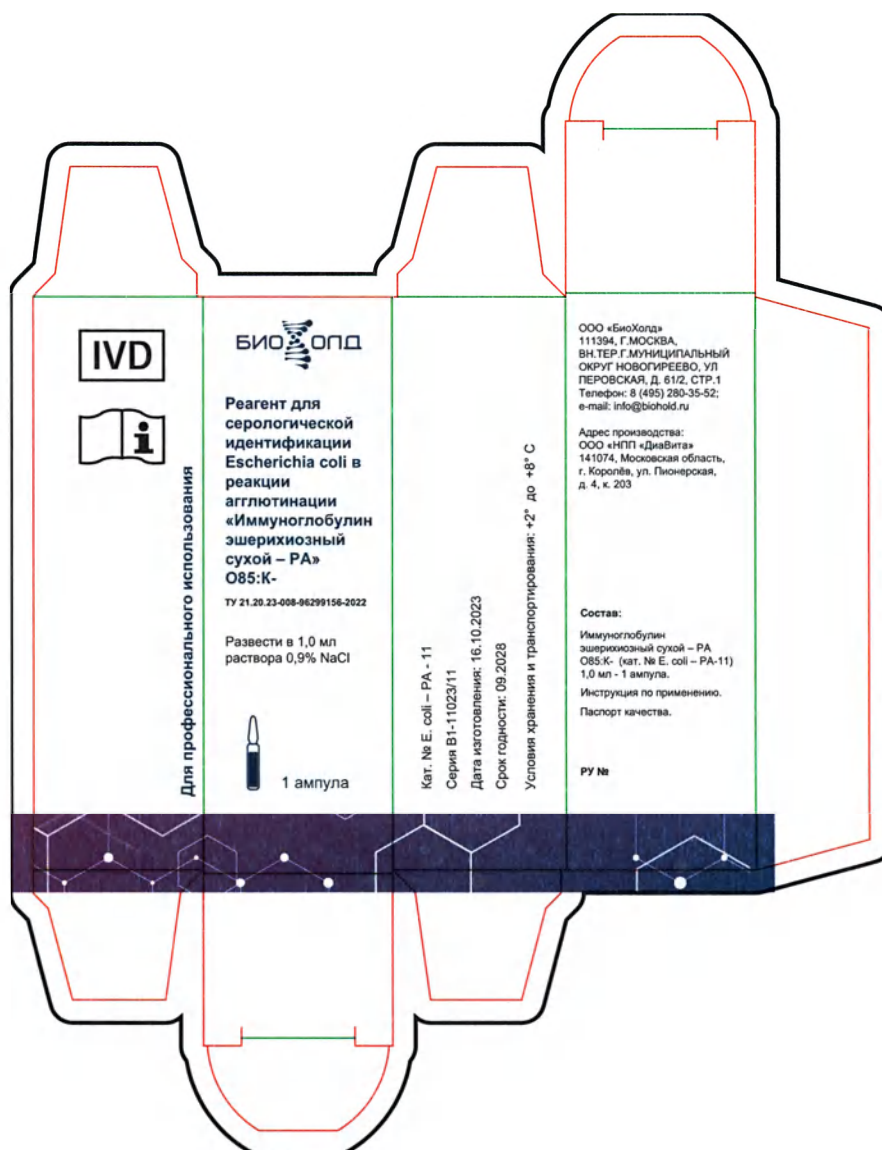

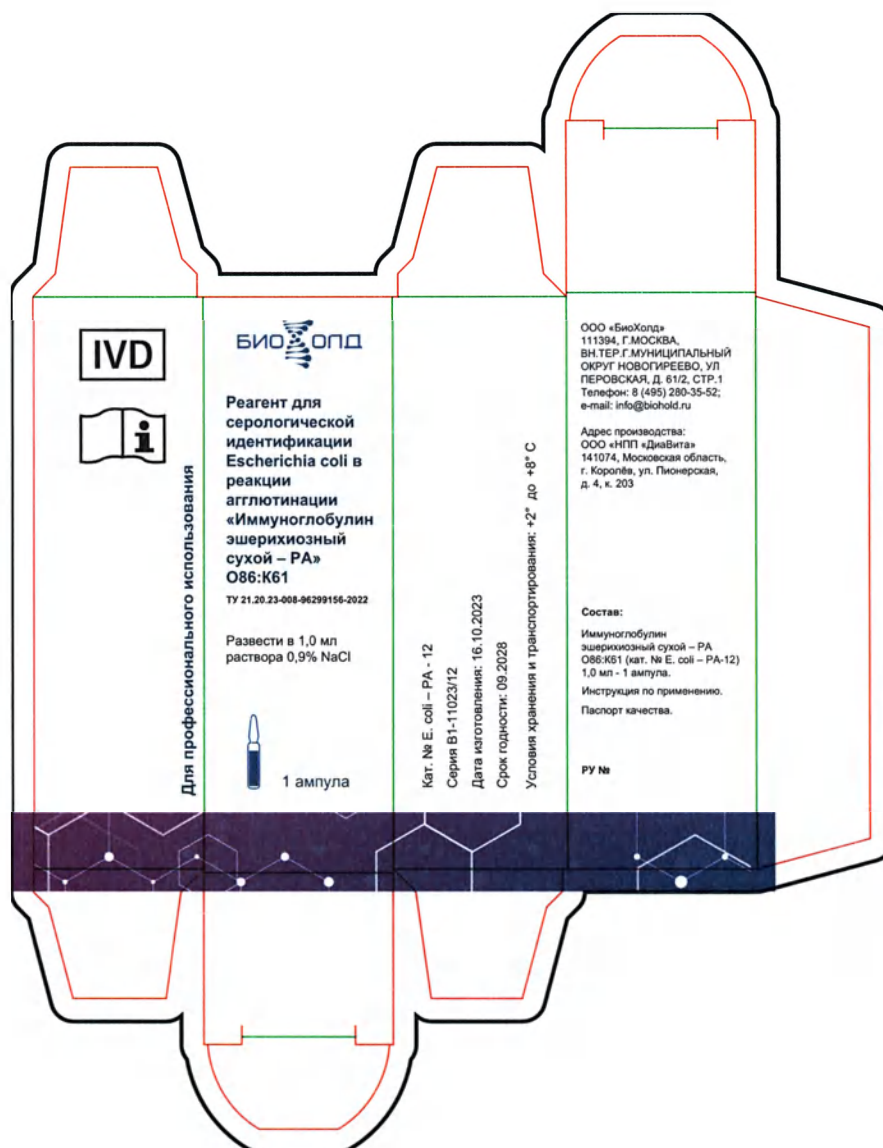

Прошито, пронумеровано
(28) лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»

И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

2024 г.

ПРОЕКТ МАКЕТА ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

O1:K1

Кат. № E.coli – PA -1
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

O6:K15


Кат. № E.coli – PA -2
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НГП «ДиеВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299158-2022
O20:K84


Кат. № E.coli – РА -3
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НГП «ДиеВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299158-2022
O25:K11

Кат. № E.coli – РА -4
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokhold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
Q26:K80

Кат. № E.coli – РА -5
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokhold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
Q26:K73

Кат. № E.coli – РА -6
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-62
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

О32:К-

Кат. № E.coli – РА -7

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-62
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

О44:K74

Кат. № E.coli – РА -8

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НГП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O55:K59

Кат. № E.coli – РА -9

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НГП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O75:K95

Кат. № E.coli – РА -10

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГУРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokhold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O85:K-**

Кат. № E.coli – РА -11

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГУРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokhold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O86:K81**

Кат. № E.coli – РА -12

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O111:K58


Кат. № E.coli – РА -13
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O112:K66

Кат. № E.coli – РА -14
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O112:K68

Кат. № E.coli – РА -15

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O114:K90

Кат. № E.coli – РА -16

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O119:K69**

Кат. № E.coli – РА -17


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O124:K72**

Кат. № E.coli – РА -18


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O125:K70

Кат. № E.coli – РА -19

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biokold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O126:K71

Кат. № E.coli – РА -20


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O127:K63

Кат. № E.coli – РА -21

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O128:K67

Кат. № E.coli – РА -22

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O142:K86

Кат. № E.coli – РА -23

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O143:K-

Кат. № E.coli – РА -24

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О144:K-

Кат. № E.coli – РА -25

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О151:K-

Кат. № E.coli – РА -26

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

7

ООО «БиоХолд»
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к.203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Иммуноглобулин эшерихиозный сухой – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
0164:K-


Кат. № E.coli – РА -27
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Прошито, пронумеровано
(15 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
И.В. Радюшкин