


УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КардиоКВАРК»
С.Б. Маслов
« 8 » октября 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия и
принадлежностей
№ФИ-КК-001

Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK по
ТУ 26.60.12-003-01446790-2021

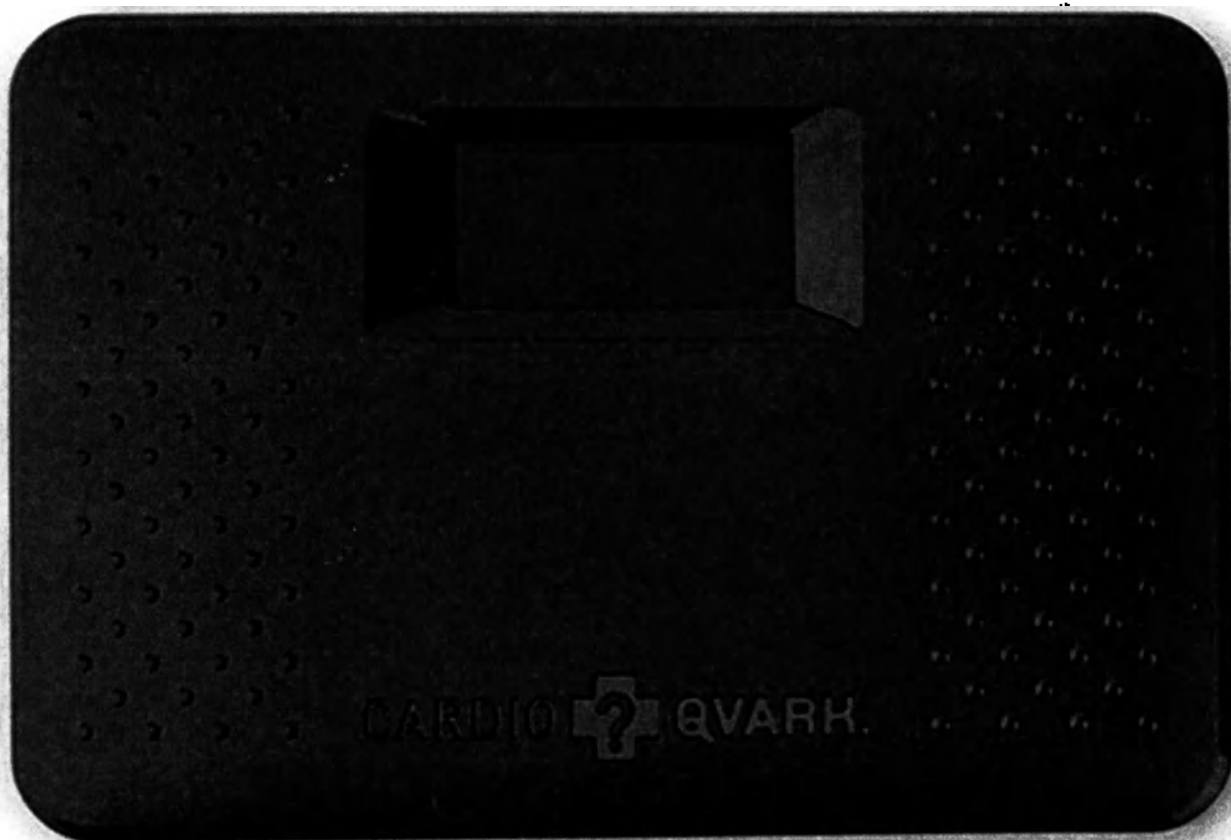

CARDIO QVARK.

**Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK
по ТУ 26.60.12-003-01446790-2021**

РУ № МИ - _____

Изготовитель:

ООО "КардиоКВАРК"

Тел./факс:

+7 985 717 05 25

E-mail:

info@cardioqvark.ru

Сайт:

www.cardioqvark.ru

Серийный номер:

Дата изготовления:

« ____ » _____ г.

Гарантийный срок:


1 год

Срок службы:


не менее 2 лет



*Фотографическое изображение 1– Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK по ТУ
26.60.12-003-01446790-2021, общий вид*



Фотографическое изображение 2– Карточка-регистратор CardioQVARK, вид спереди

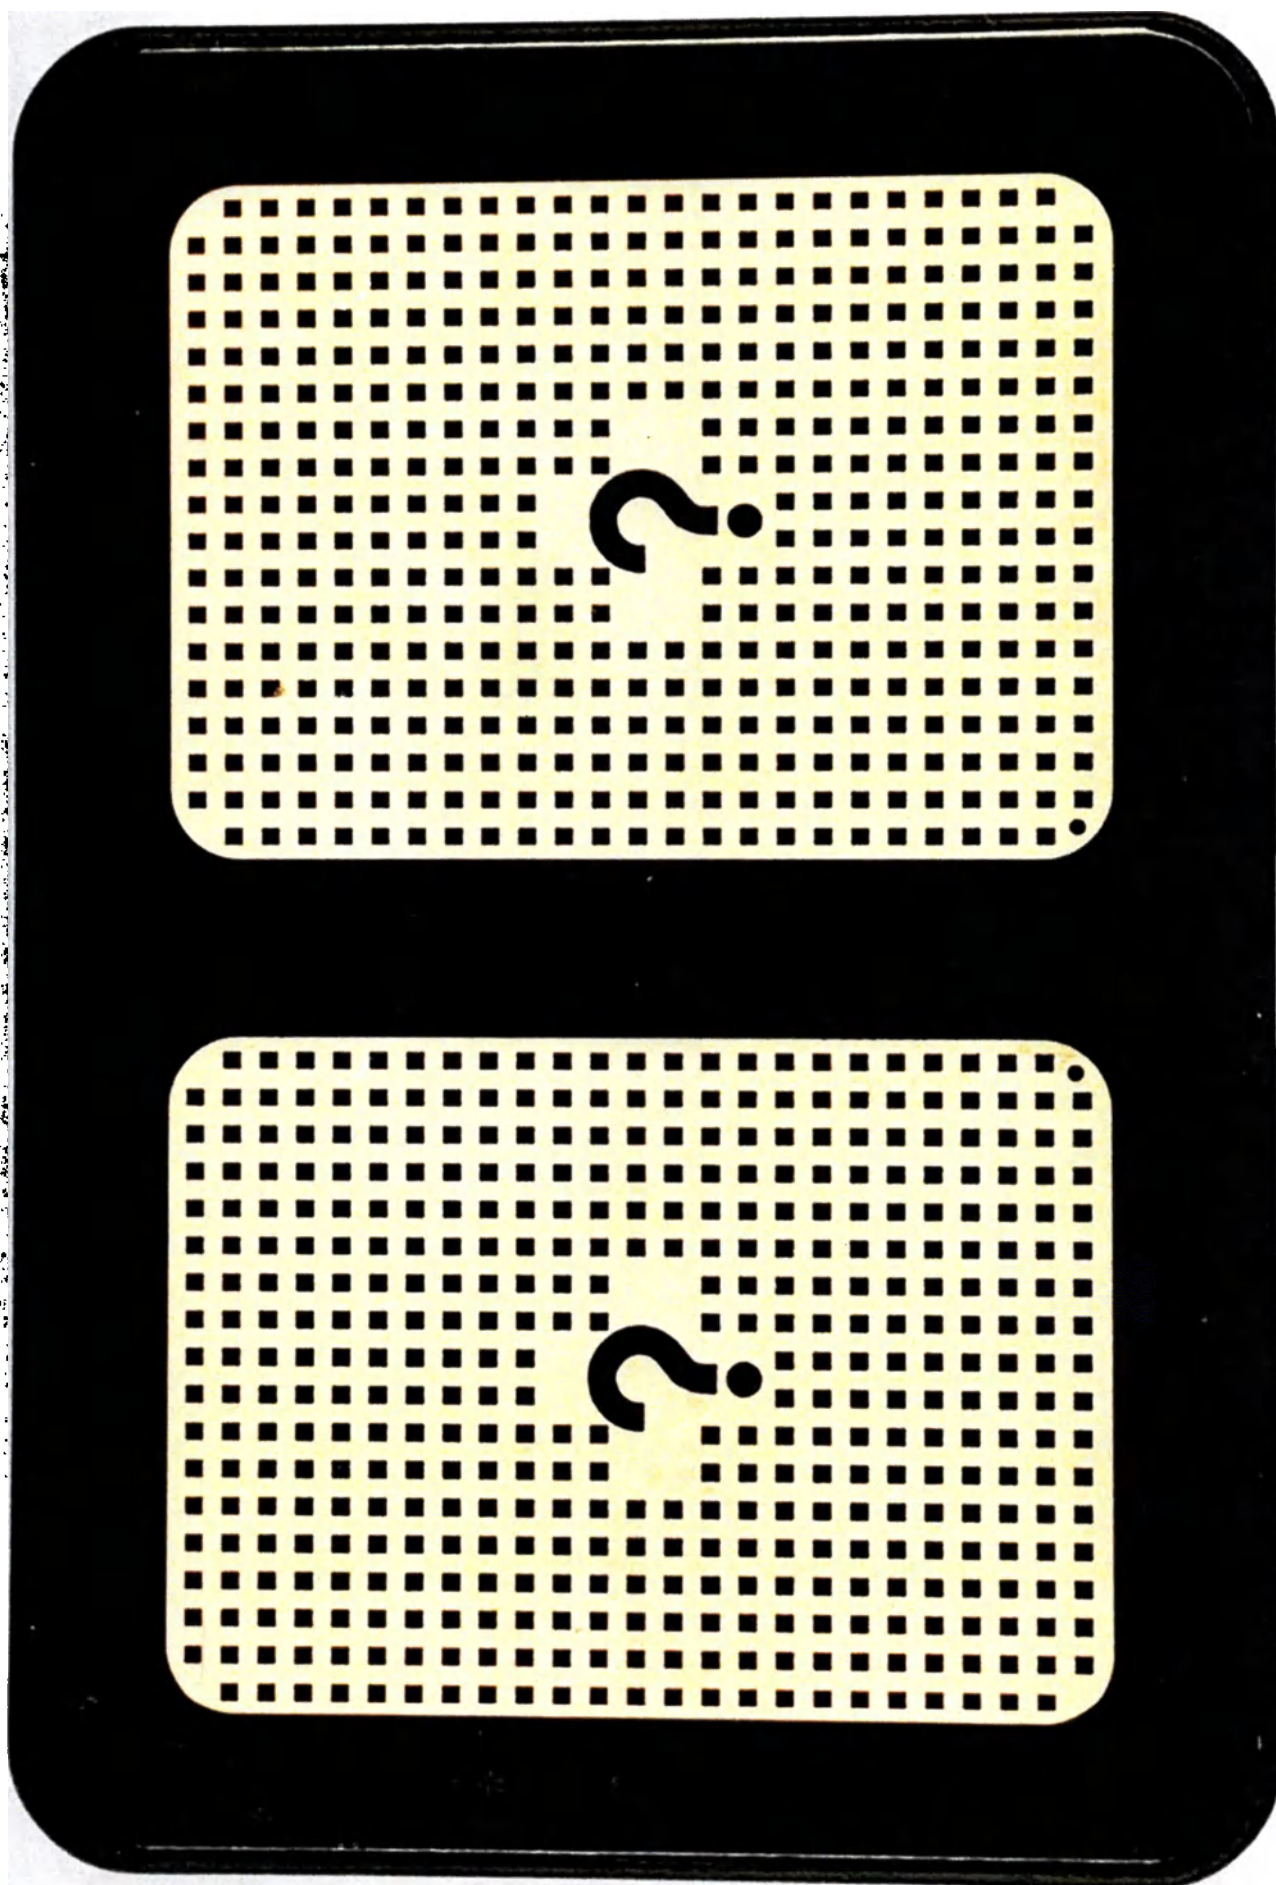

Фотографическое изображение 3 – Карточка-регистратор CardioQVARK, вид сзади



Фотографическое изображение 4 – Карточка-регистратор CardioQVARK, вид сбоку

CARDIO QVARK.

Персональное устройство
для регистрации кардиоритма

QR-код на адресное размещение
ПО «КардиоКАРТА»
в облачном пространстве



CARDIO QVARK.

Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK
по ТУ 26.60.12-003-01446790-2021

РУ № МИ - ____ - ____

Габариты упаковки(ДхШхВ), мм:

Страна-изготовитель: Россия

Изготовитель: ООО "КардиоКВАРК"

Место производства: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, дом 5,
корпус 4, этаж/комн 5/4

Тел./факс: +7 985 717 05 25

E-mail: info@cardioqvark.ru

Сайт: www.cardioqvark.ru

Постоянное напряжение питания: 5В

Ток потребления: Не более 50мА

Серийный номер:

Дата изготовления: « ____ » _____ г.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: не менее 2 лет

Руководство по эксплуатации доступно на сайте
www.cardioqvark.ru. По запросу руководство предоставляется
в распечатанном виде.



© CardioQVARK, 2022. Все права защищены.

СДЕЛАНО В РОССИИ

108565
27.12.2023

CARDIO  QVARK.

ID

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

Восстановить пароль

Фотографическое изображение 6 – ПО «КардиоКАРТА»
(Основной экран, Android)



Восстановить пароль

Введите E-mail, указанный при регистрации
учетной записи

Email

Восстановить пароль



*Фотографическое изображение 7 – ПО «КардиоКАРТА»
(Восстановление пароля, Android)*



Зарегистрироваться

Пароль

Пароль может содержать только цифры и латинские буквы

Фамилия


Имя

Отчество

Необязательное поле

Email

user@example.com

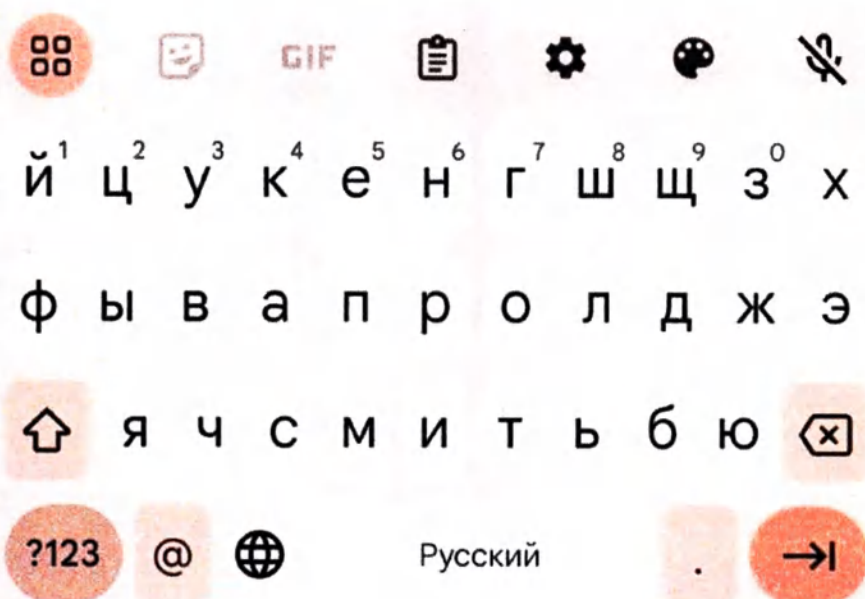

Фотографическое изображение 8 – ПО «КардиоКАРТА»
(Регистрация, Android)



Список записей



CardioQVARK С. С.

ЭКГ 31

5 ноября 2022 г.**2 ноября 2022 г.**

15:53

ЧСС 102**1 ноября 2022 г.**

15:53

ЧСС 76**1 ноября 2022 г.**

15:53

ЧСС 76**29 октября 2022 г.**

15:53

ЧСС 83**29 октября 2022 г.**

15:53

ЧСС 83

16:06

98 %

← Настройки

Версия ПО

1.3.2.0

Поиск устройств

Фотографическое изображение 10 – ПО «КардиоКАРТА»
(Настройки, Android)

15:54

98 %



Поиск устройств

Идет поиск устройств...

CardioCARD

C2:65:70:92:FC:A3



*Фотографическое изображение 11 – ПО «КардиоКАРТА»
(Поиск устройств, Android)*

15:54

98 %

← Настройки

Версия ПО 1.3.2.0

CardioCARD Подключено

Забыть устройство

Проверка наличия обновления прошивки

Фотографическое изображение 12 – ПО «КардиоКАРТА»
(Подключенное устройство, Android)

15:55

98 %



Просмотр записи



ФИО: Кардиокарта С Q

CARDIO  QVARK

Пол: Мужской

Возраст: 35

Вес: 99


Рост: 192

Дата: 2022-11-03

Время: 16:23:22 UTC+3

ЧСС: 85/мин

Фильтр: 50 Гц; 0.5-35 Гц; ЦФВЧ, 25 мм/с 10 мм/мВ

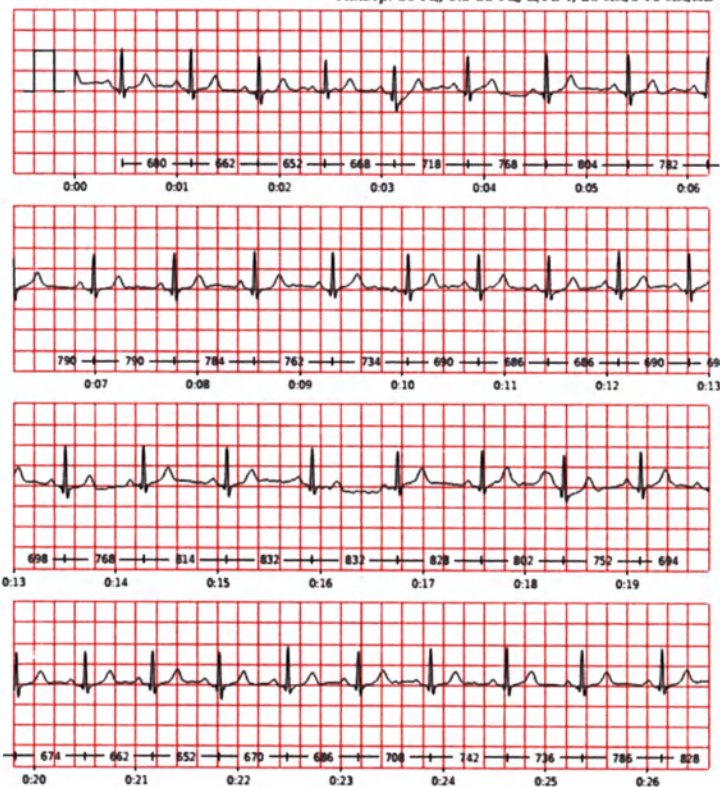

(c) CardioQVARK IDp 13088

Стр. 1 из 3

Фотографическое изображение 13 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 1 из 3), Android)

15:55


98 %



Просмотр записи



CARDIO QVARK

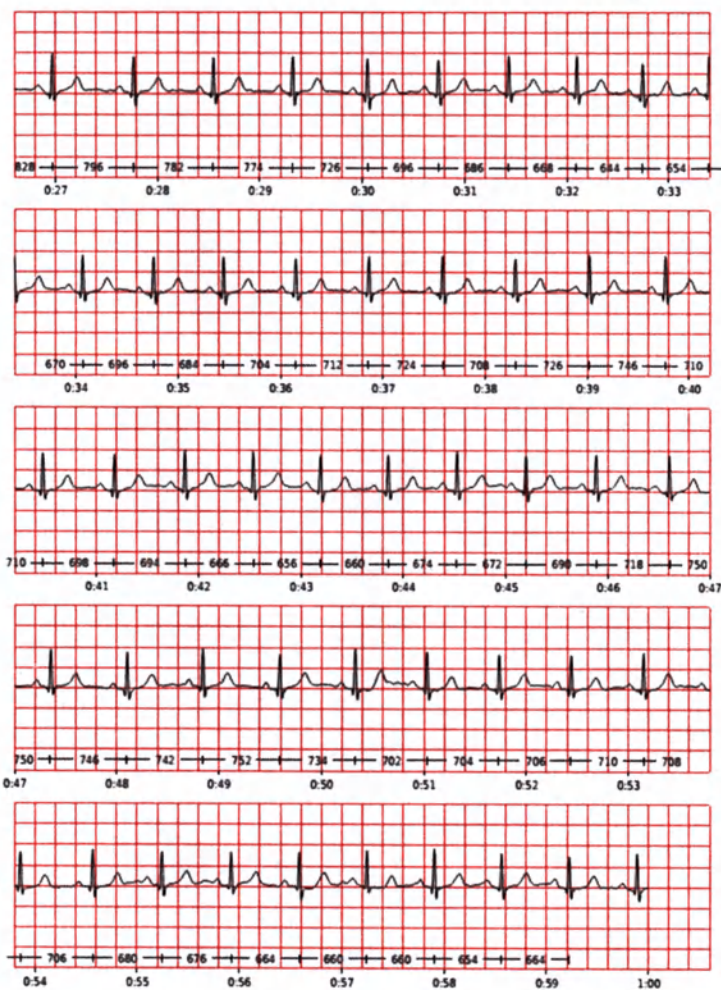

©1 CardioQVARK IDp 13088

Стр. 2 из 3

Фотографическое изображение 14 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 2 из 3), Android)

15:55

98 %



Просмотр записи




CARDIO QVARK

Кардиоинтервалограмма



Скаттерограмма



Параметры ВСР

HR	= 84	/мин	LF	= 1749.8	мс ²
Extr	= 0	шт.	HF	= 63.4	мс ²
SDNN	= 50.7	мс	LF/HF	= 27.6	
TP	= 2180.3	мс ²	SI	= 101.6	о.е.

(c) CardioQVARK IDp 13088

Регистрация в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Информация о регистрации доступна на сайте: www.goszdraznadzor.ru

Стр. 3 из 3

Фотографическое изображение 15 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 3 из 3), Android)



ID

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

Восстановить пароль



Восстановить пароль

Введите E-mail, указанный при регистрации
учетной записи

Email

Восстановить пароль



Зарегистрироваться

Фамилия


Имя

Отчество

Необязательное поле

Email

user@example.com

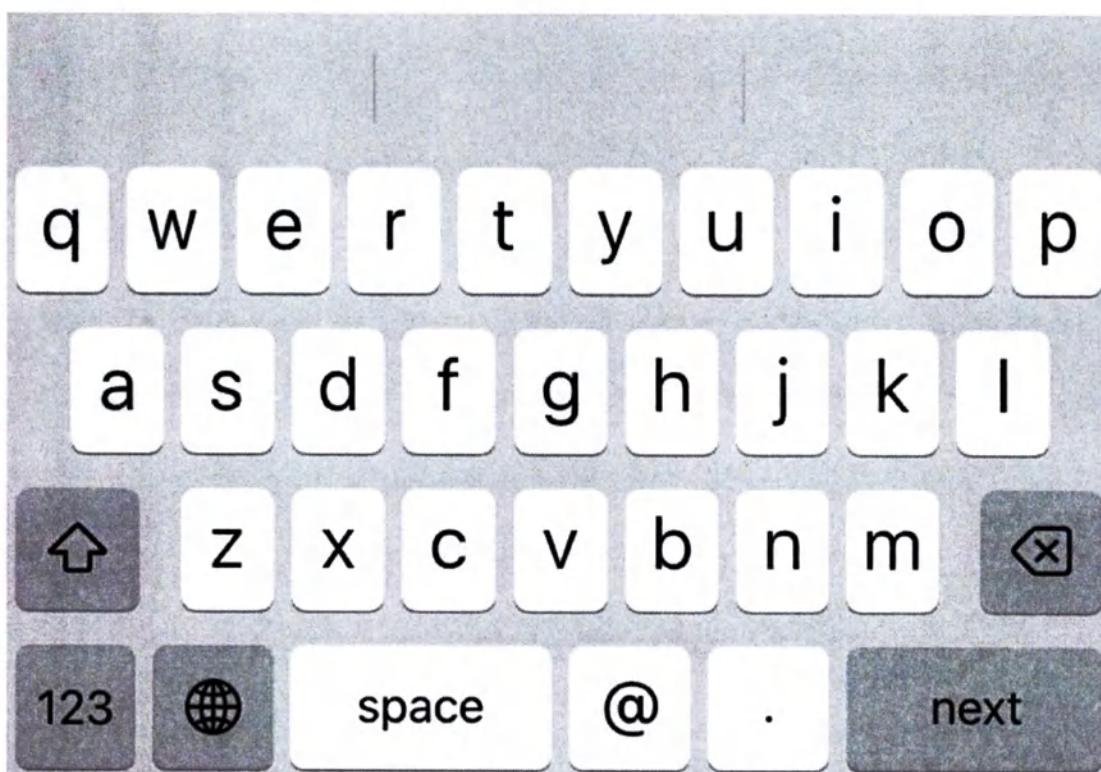

Фотографическое изображение 178 – ПО «КардиоКАРТА»
(Регистрация, IOS)



Список записей



CardioQVARK C. C.

ЭКГ 33

3 ноября 2022 г.

16:23

ЧСС 85

16:13

ЧСС 77

16:03

ЧСС 119**2 ноября 2022 г.**

15:53

ЧСС 102**1 ноября 2022 г.**

15:53

ЧСС 76**31 октября 2022 г.**

15:53

ЧСС 54

Фотографическое изображение 189 – ПО «КардиоКАРТА»
(Список записей, IOS)



Настройки

Версия ПО

1.3.2.0

Поиск устройств

Фотографическое изображение 20 – ПО «КардиоКАРТА»
(Настройки, IOS)



Поиск устройств

Идет поиск устройств...

CardioCARD

2B329B8B-FC20-205B-271D-DA4789422F05

Фотографическое изображение 191 – ПО «КардиоКАРТА»
(Поиск устройств, IOS)



Настройки

Версия ПО

1.3.2.0

CardioCARD

Подключено

Забыть устройство

Проверка наличия обновления прошивки

Фотографическое изображение 202 – ПО «КардиоКАРТА»
(Подключенное устройство, IOS)



Просмотр ...



ФИО: Кардиокарта С Q

CARDIO  QVARK.

Пол: Мужской

Возраст: 35

Вес: 99





Рост: 192

Дата: 2022-11-03

Время: 16:23:22 UTC+3

ЧСС: 85/мин

Фильтр: 50 Гц; 0.5-35 Гц; ЦФВЧ, 25 мм/с 10 мм/мВ

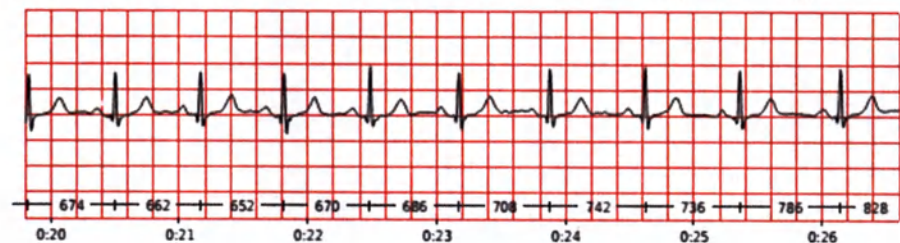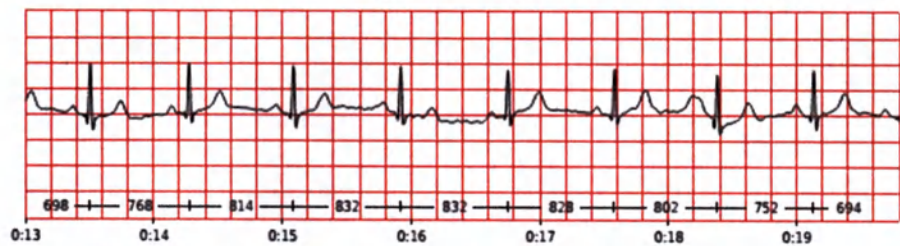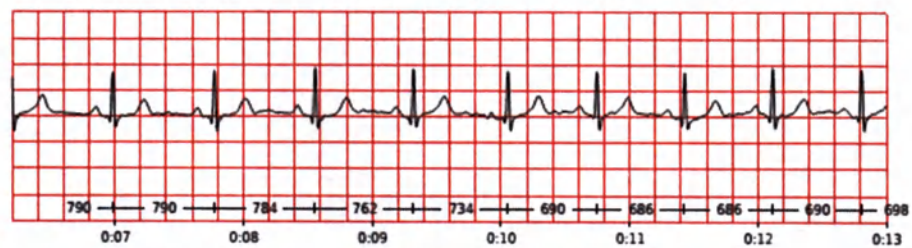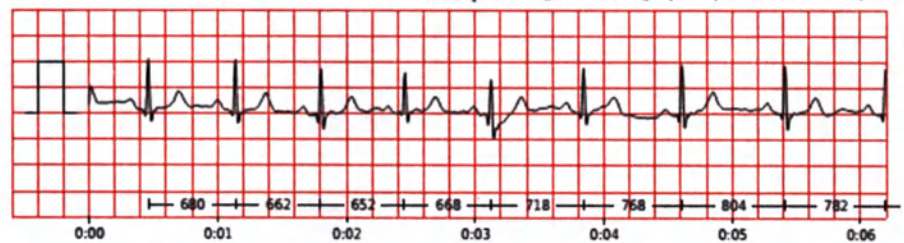

(c) CardioQVARK IDp 13088

Стр. 1 из 3


Фотографическое изображение 213 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 1 из 3), IOS)



Просмотр ...



CARDIO QVARK.

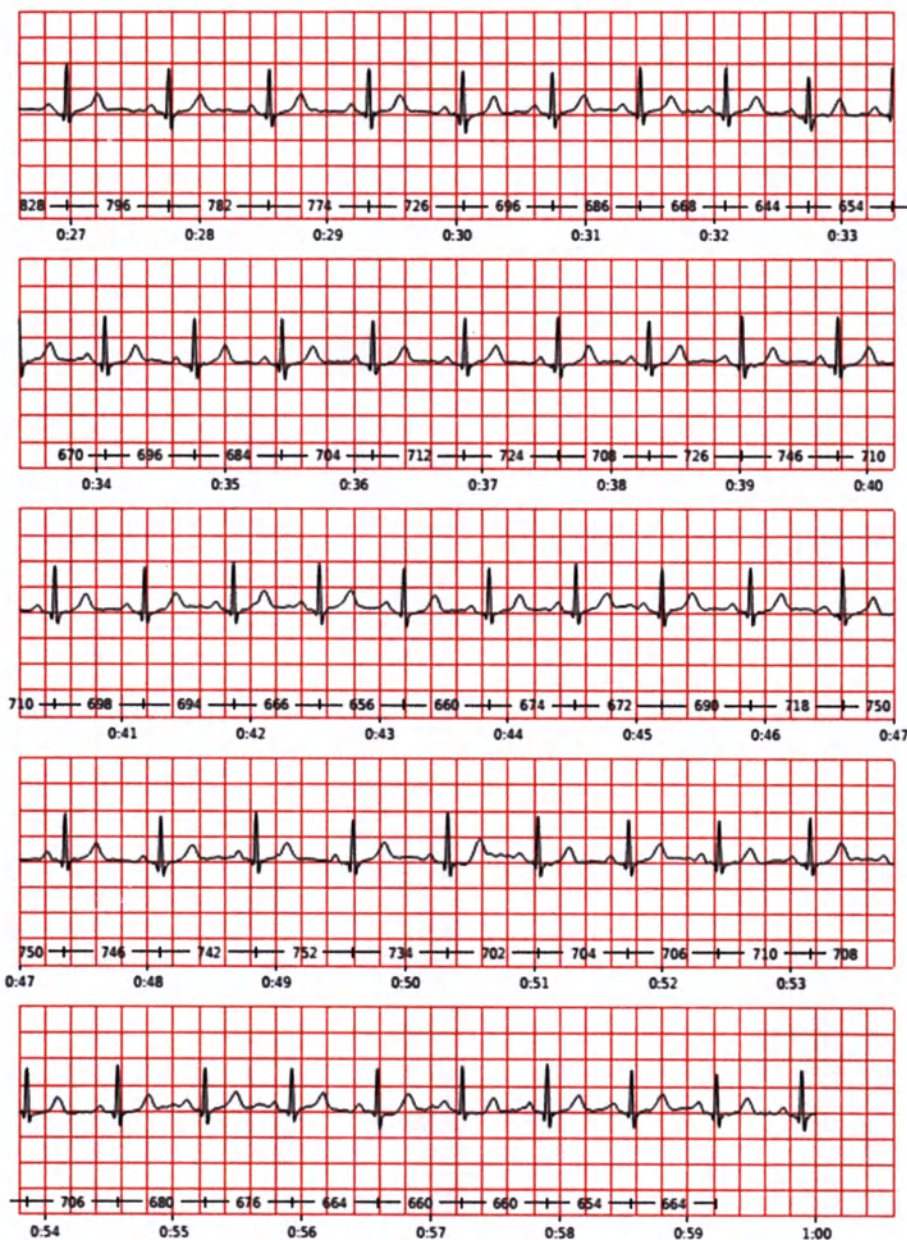

(c) CardioQVARK IDp 13088

Стр. 2 из 3


Фотографическое изображение 224 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 2 из 3), IOS)




Просмотр ...

CARDIO  QVARK.

Кардиоинтервалограмма

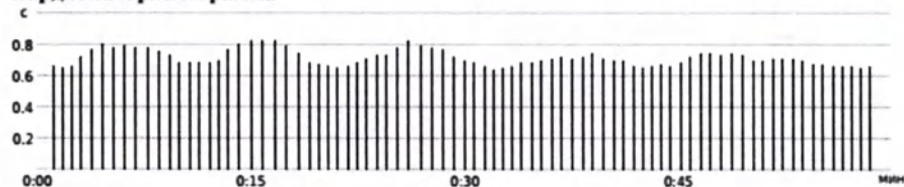

Скаттерограмма



Параметры ВСР

HR	= 84	/мин	LF	= 1749.8	мс ²
Extr	= 0	шт.	HF	= 63.4	мс ²
SDNN	= 50.7	мс	LF/HF	= 27.6	
TP	= 2180.3	мс ²	SI	= 101.6	о.е.

(с) CardioQVARK IDp 13088

Выход выполнен в автоматическом режиме, требуется подтверждение врача.
Обязательно проверить результаты - изменить при необходимости полученные результаты.

Стр. 3 из 3

Фотографическое изображение 235 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 3 из 3), IOS)

CARDIO  ПАЦИЕНТ

ID учетной записи

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

Восстановление доступа пациента

Фотографическое изображение 246 – ПО «КардиоКАРТА»
(Меню входа, Windows)

← Регистрация

Пароль *

Фамилия *

Имя *


Отчество

E-mail *

*Фотографическое изображение 257 – ПО «КардиоКАРТА»
(Меню регистрации, Windows)*



Фотографическое изображение 268 – ПО «КардиоКАРТА»
(Основной экран, Windows)

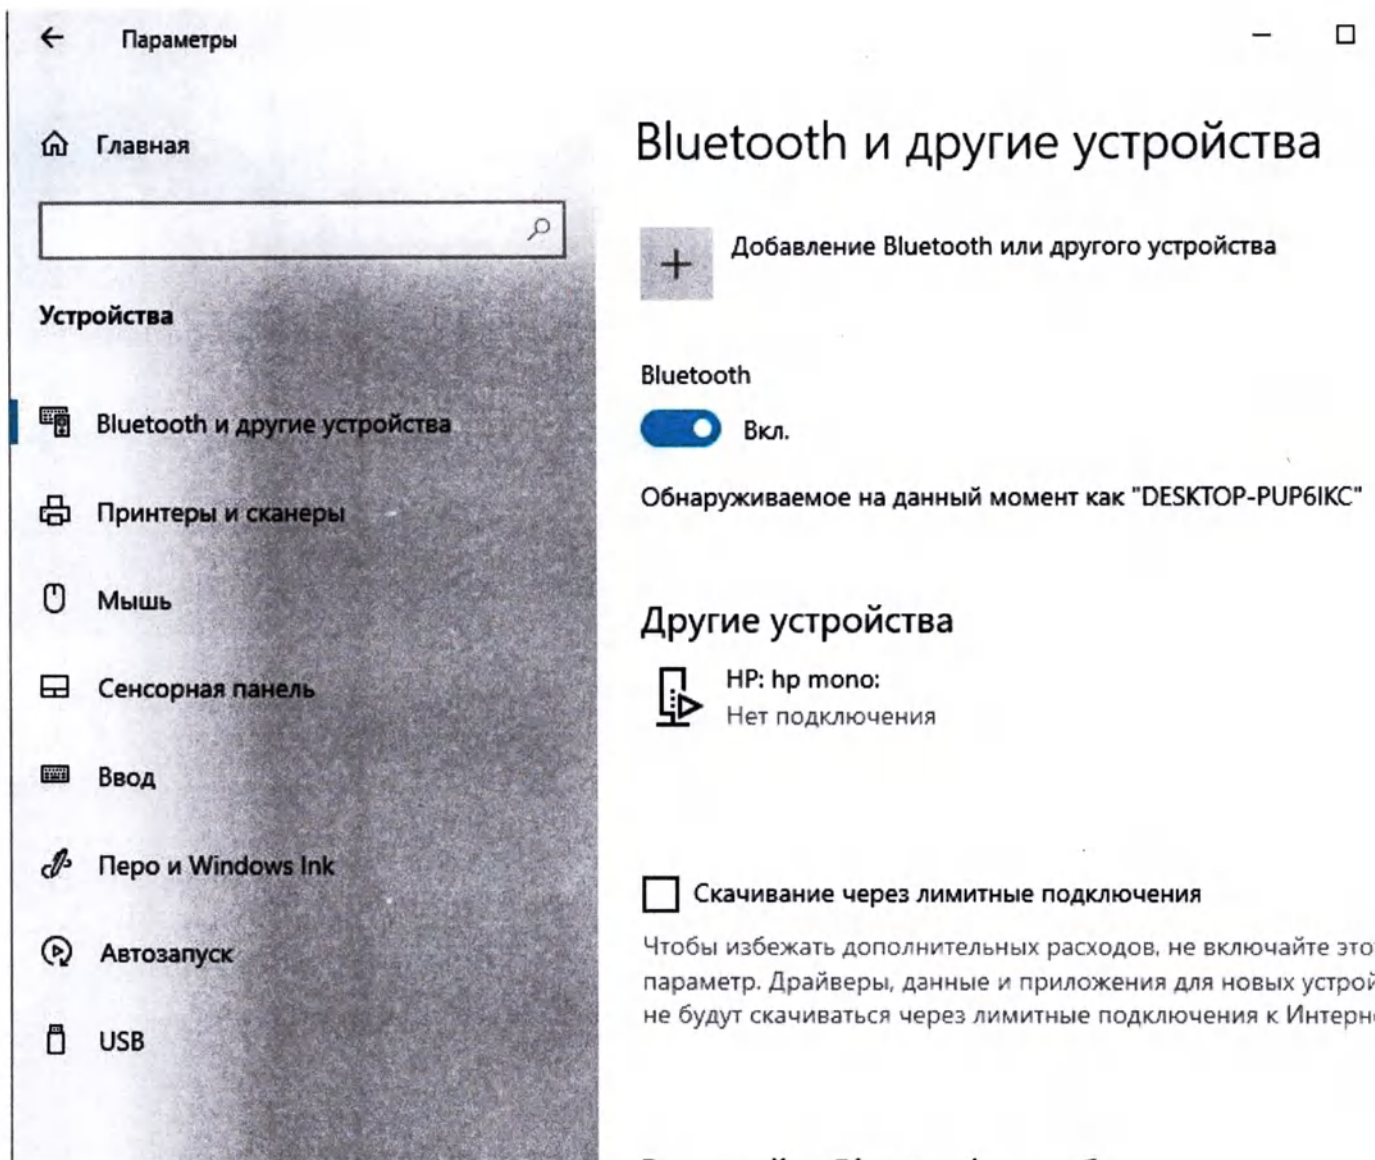

Фотографическое изображение 279 – ПО «КардиоКАРТА»
(Экран подключения комплекса стандартными средствами Windows.)

Добавить устройство


Убедитесь, что ваше устройство включено и доступно для обнаружения.
Выберите устройство ниже, чтобы подключиться.



CardioCARD

Отмена

*Фотографическое изображение 30 – ПО «КардиоКАРТА»
(Экран подключения комплекса стандартными средствами Windows.)*

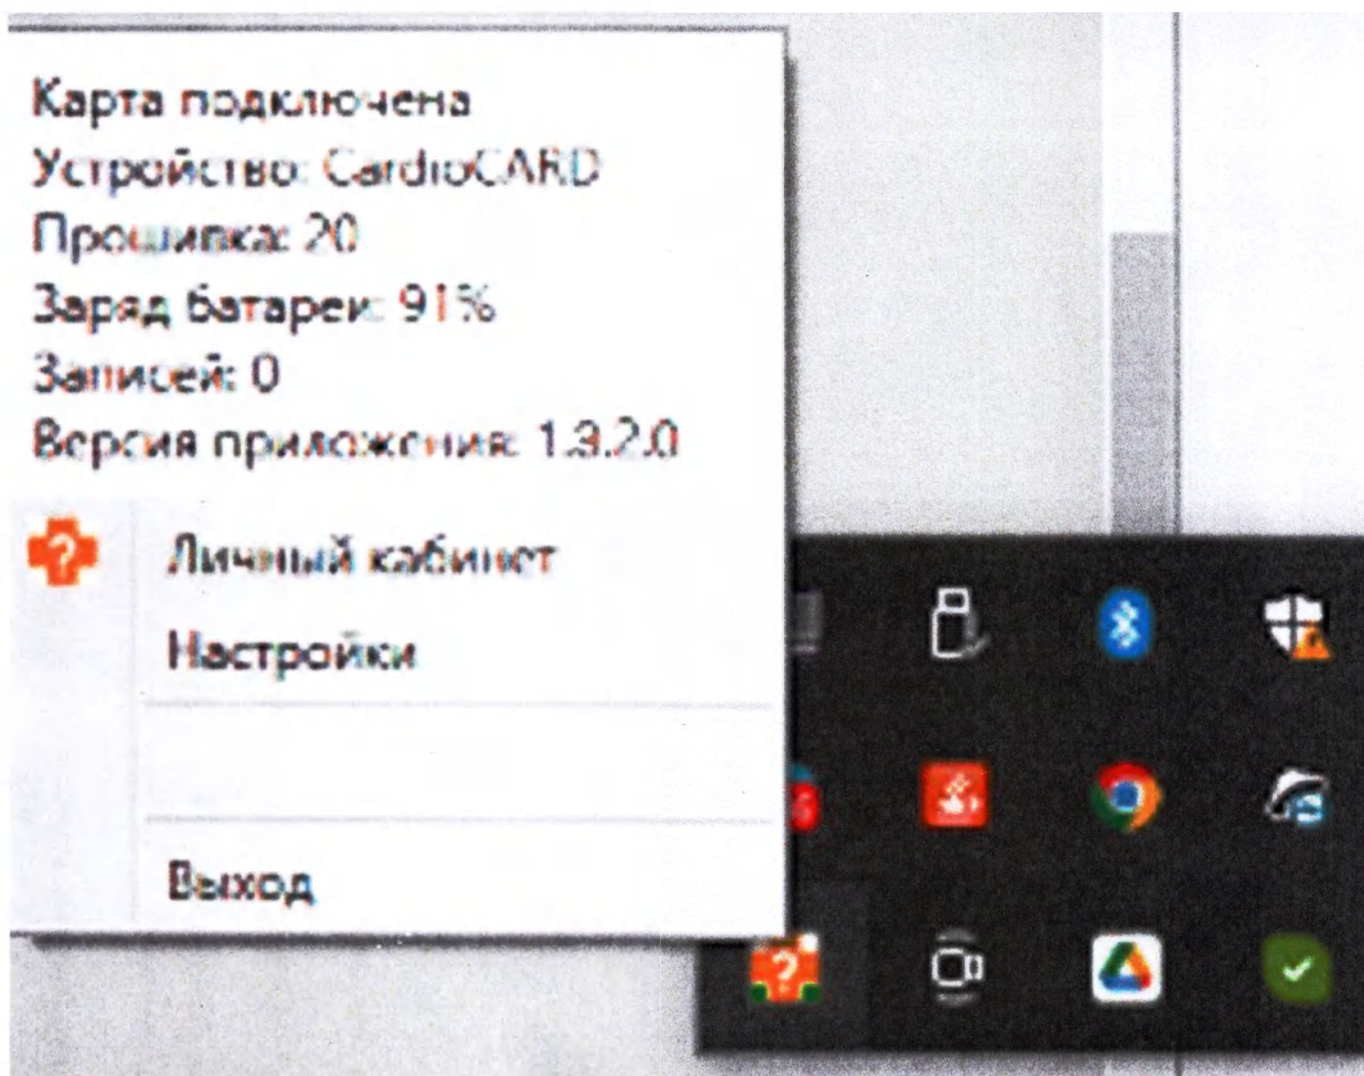

Фотографическое изображение 31 – ПО «КардиоКАРТА»
(Экран статус подключения комплекса в приложении КардиоКАРТА)

ФИО: Кардиокарта С Q

CARDIO  QVARK

Пол: Мужской

Возраст: 35

Вес: 99





Рост: 192

Дата: 2022-11-03

Время: 16:23:22 UTC+3

ЧСС: 85/мин


Фильтр: 50 Гц; 0.5-35 Гц; ЦФВЧ, 25 мм/с 10 мм/мВ

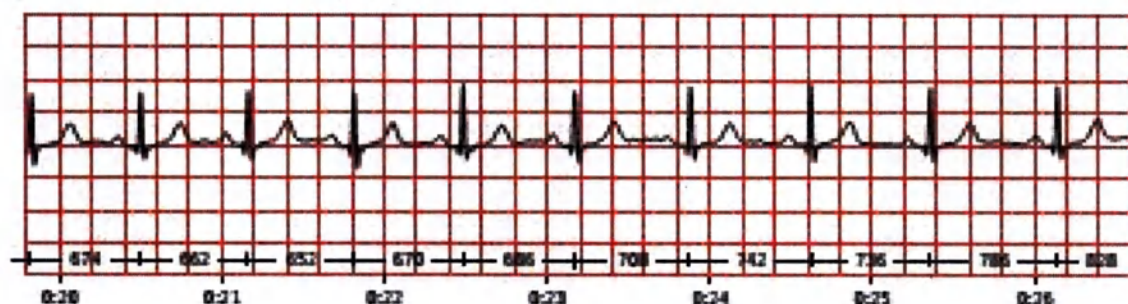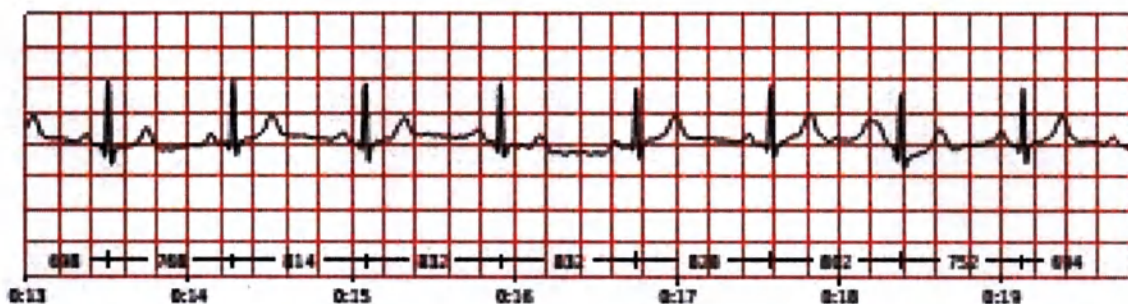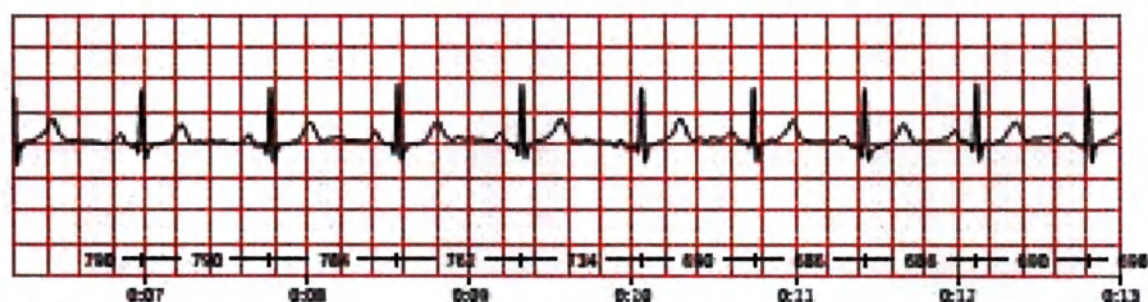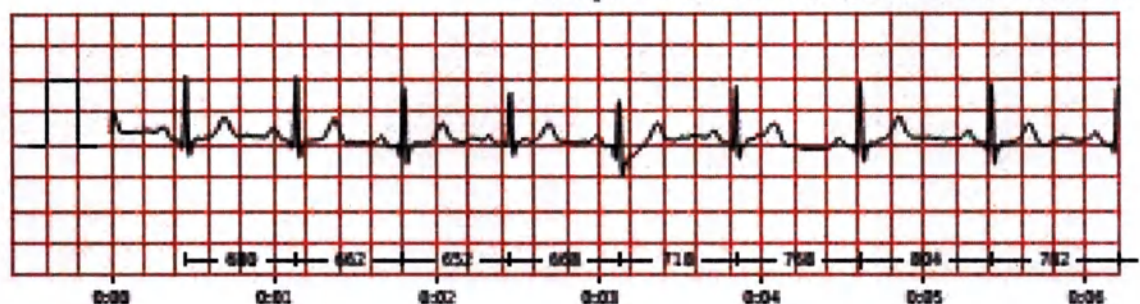

© CardioQVARK Вер. 1.0000

Стр. 1 из 3

Фотографическое изображение 282 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 1 из 3), Windows)

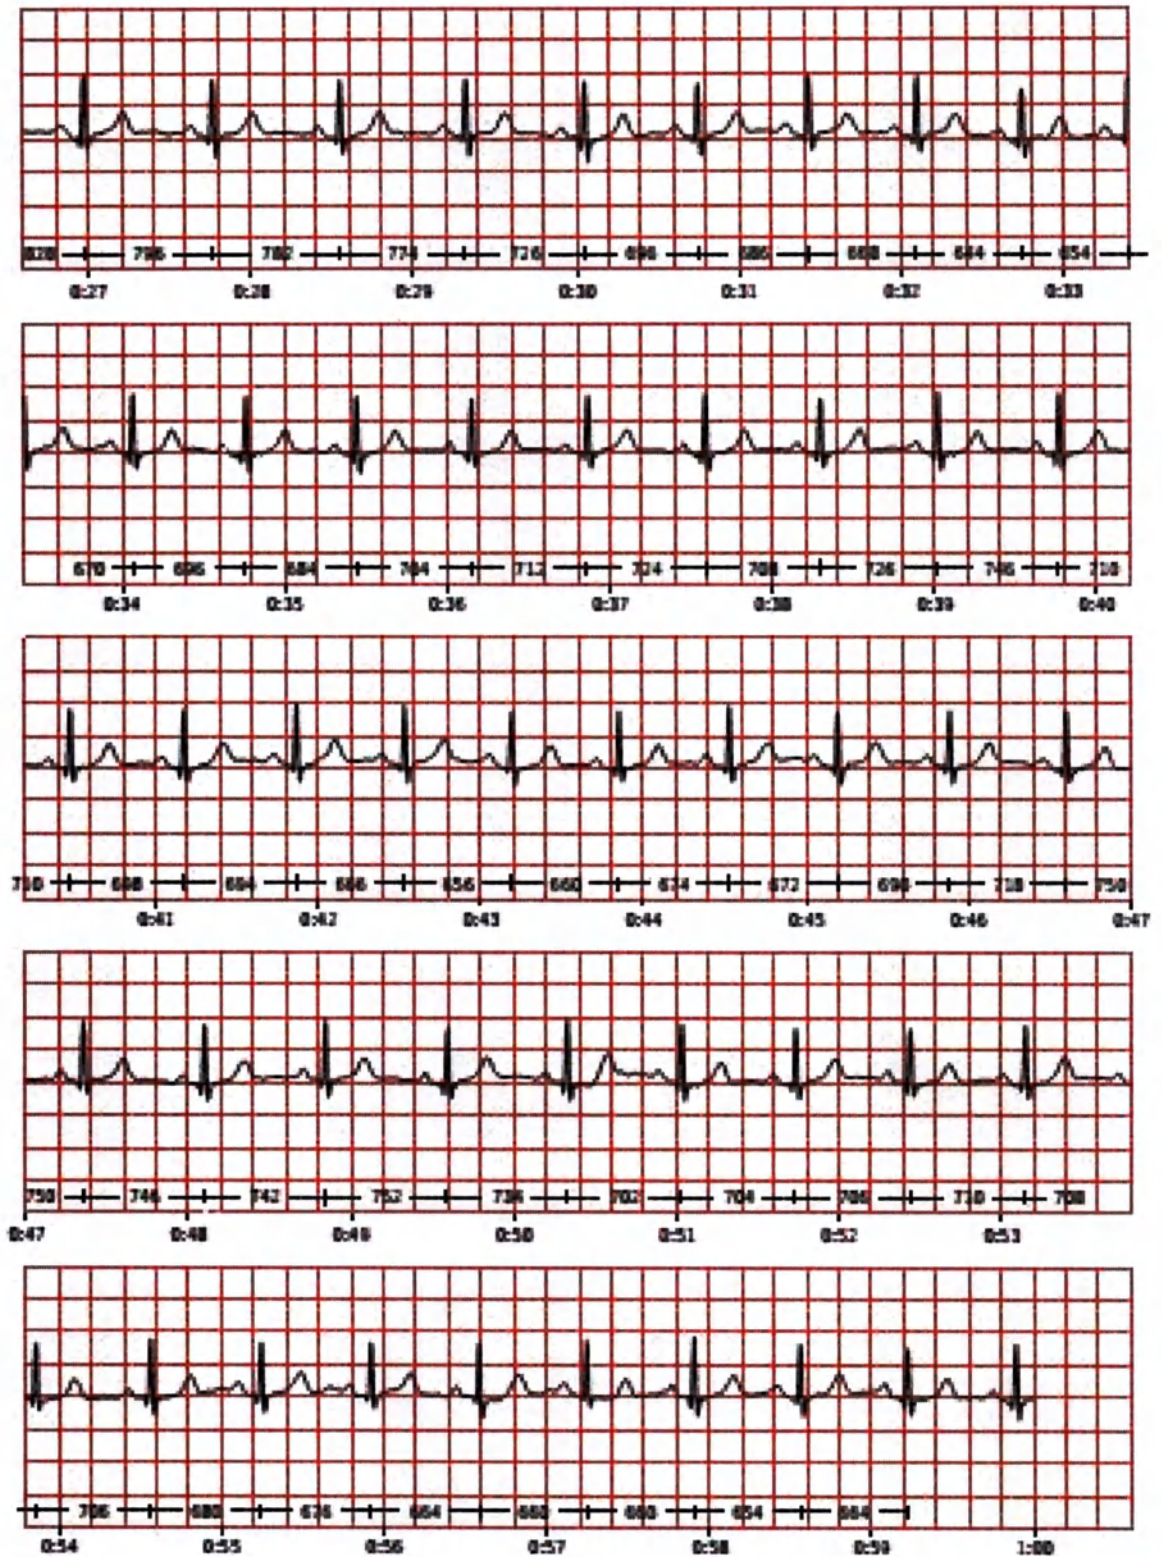

sc CardioQVARH. Вер. 1.0000


Стр. 2 из 3

Фотографическое изображение 293 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 2 из 3), Windows)

Кардиоинтервалограмма



Скаггтерограмма

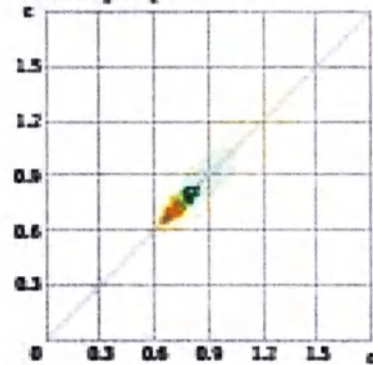

Параметры ВСР

HR	= 84	/мин	LF	= 1749.8	мс ²
Extr	= 0	шт.	HF	= 63.4	мс ²
SDNN	= 50.7	мс	LF/HF	= 27.6	
TP	= 2180.3	мс ²	SI	= 101.6	о.е.

Фотографическое изображение 304 – ПО «КардиоКАРТА»
(Просмотр записи (стр. 3 из 3), Windows)

CARDIO QVARK.

**Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK
по ТУ 26.60.12-003-01446790-2021**

РУ № МИ - _____

Изготовитель: ООО "КардиоКВАРК"

Тел./факс: +7 985 717 05 25

E-mail: info@cardioqvark.ru

Сайт: www.cardioqvark.ru

Серийный номер:

Дата изготовления: «____» _____ г.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: не менее 2 лет



Фотографическое изображение 315 – Чехол изделия (маркировка)



Фотографическое изображение 326 – Транспортная упаковка

CARDIO QVARK.

Комплекс программно-аппаратный CardioQVARK

по ТУ 26.60.12-003-01446790-2021

РУ № МИ- _____

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм: _____

Вес, кг: _____

Страна-изготовитель: _____

Изготовитель: _____

Место производства: _____

Тел./факс: _____

E-mail: _____

Сайт: _____

Россия

ООО "КардиоКВАРК"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
дом 5, корпус 4, этаж/комн 5/4

+7 985 717 05 25

info@cardioqvark.ru

www.cardioqvark.ru

Количество: _____

Дата изготовления: _____

Гарантийный срок: _____

Срок службы: _____

« _____ » _____ г.

1 год

не менее 2 лет

Фотографическое изображение 337 – Маркировка транспортной упаковки

ООО «КардиокВАРК»
Итого в настоящем документе

38 листа(ов)

Генеральный директор
Маслов Сергей Борисович

