

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «СЗМИ»

Земсков А.В.



"26" *сентября* 20*24* г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Перчатки медицинские диагностические нитриловые,
текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые,
нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023**



Рисунок 1 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: «XS»



Рисунок 2 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: «S»



Рисунок 3 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: «М»



Рисунок 4 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: «L»



Рисунок 5 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: «XL»



Рисунок 6 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.

Индивидуальная упаковка 5 пар.

(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 7 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: M.

Индивидуальная упаковка 5 пар.
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера M).



Рисунок 8 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.
Индивидуальная упаковка 5 пар.
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 9 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М
Индивидуальная упаковка 5 пар.
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 10 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.

Индивидуальная упаковка 5 пар.

(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 11 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.
Индивидуальная упаковка 5 пар.
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 12 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.
Индивидуальная упаковка 25 пар.
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



Рисунок 13 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 25 пар.

(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).

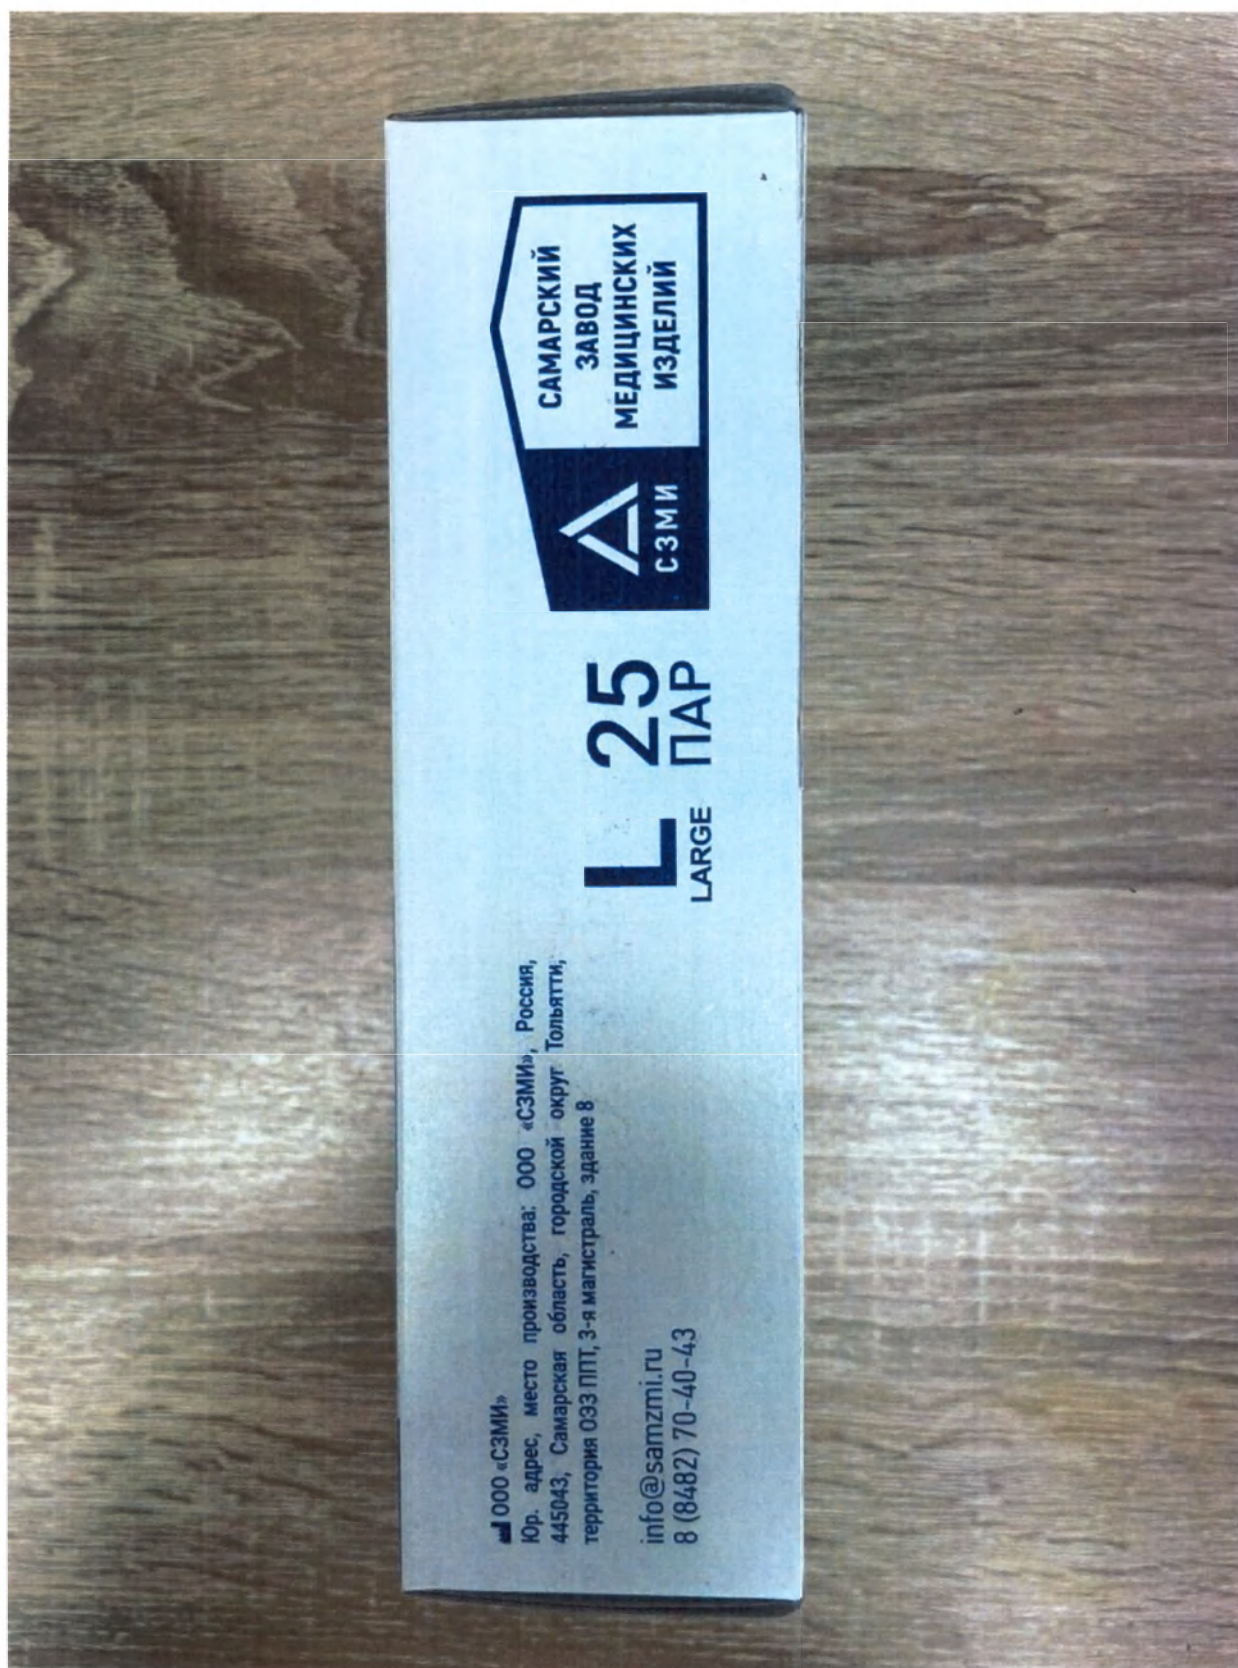


Рисунок 14 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 25 пар.

(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).

Рисунок 15 – Перчатки медицинские диатермические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.
Индивидуальная упаковка XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

Перед применением перчаток следует провести антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций и процедур.

Аккуратно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья, легкими движениями второй руки расправьте перчатку по форме руки. Для снятия медицинских перчаток сделайте отворот на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны, снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и держа за отворот. Держать ее в правой руке, взять правую перчатку левой рукой за отворот с внутренней стороны.

Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку, чтобы левая перчатка оказалась в середине правой, выбросить перчатки в мусор. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЧАТОК!

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.





Рисунок 16 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 25 пар.
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



Рисунок 17 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 25 пар.
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



Рисунок 18 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: S.
Индивидуальная упаковка 50 пар (210x120x58 мм).
(упаковка для размеров XS, M, L, XL идентична упаковке для размера S).



Рисунок 20 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: S. Индивидуальная упаковка 50 пар (210x120x58 мм). (упаковка для размеров XS, M, L, XL идентична упаковке для размера S).



Рисунок 21 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: S. Индивидуальная упаковка 50 пар (210x120x58 мм). (упаковка для размеров XS, M, L, XL идентична упаковке для размера S).



Рисунок 22 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: S.
Индивидуальная упаковка 50 пар (210x120x58 мм).
(упаковка для размеров XS, M, L, XL идентична упаковке для размера S).



Рисунок 23 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: S. Индивидуальная упаковка 50 пар (210x120x58 мм). (упаковка для размеров XS, M, L, XL идентична упаковке для размера S).



Рисунок 24 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.
Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 25 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.
Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 26 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М. Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72). (упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 27 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М. Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72). (упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 28 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.
Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 29 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: М.

Индивидуальная упаковка 100 пар (245x135x72).

(упаковка для размеров XS, S, L, XL идентична упаковке для размера М).



Рисунок 30 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 50 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S,M, XL идентична упаковке для размера L).

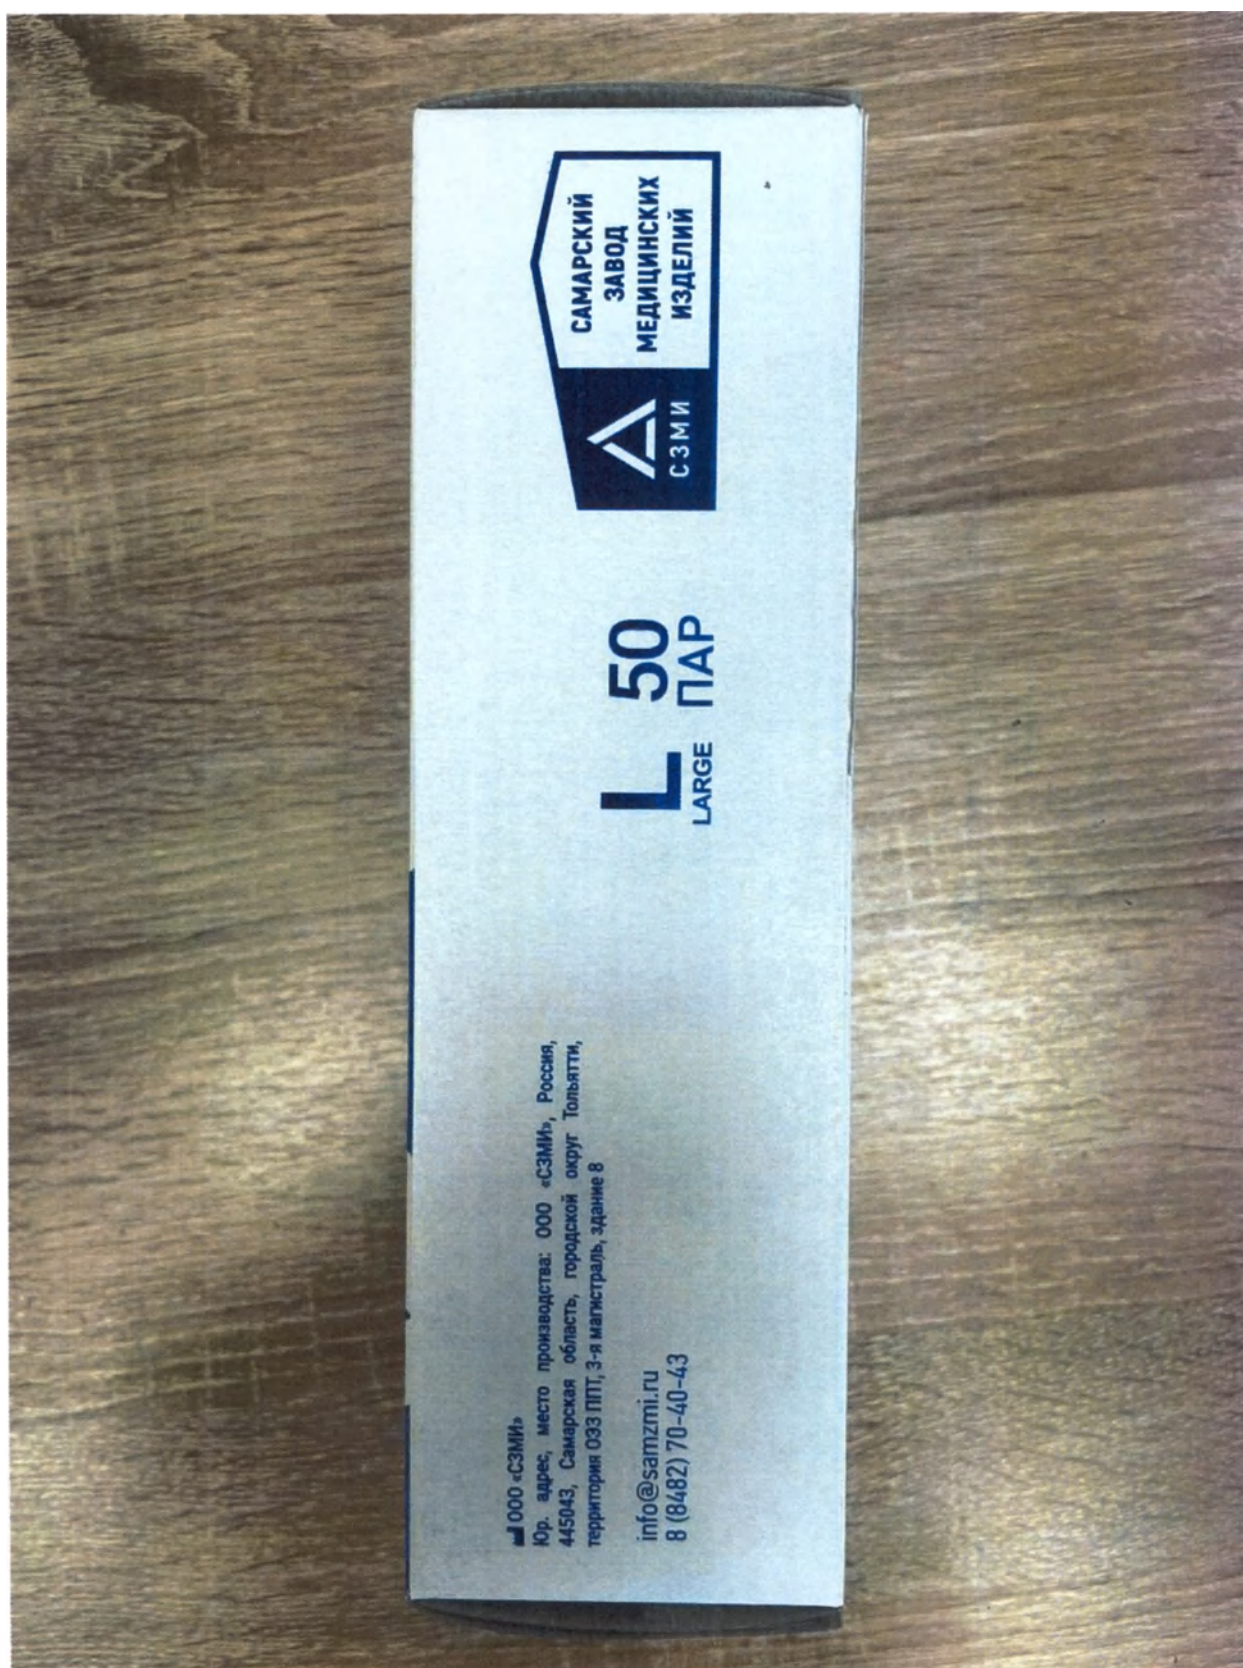


Рисунок 32 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 50 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).

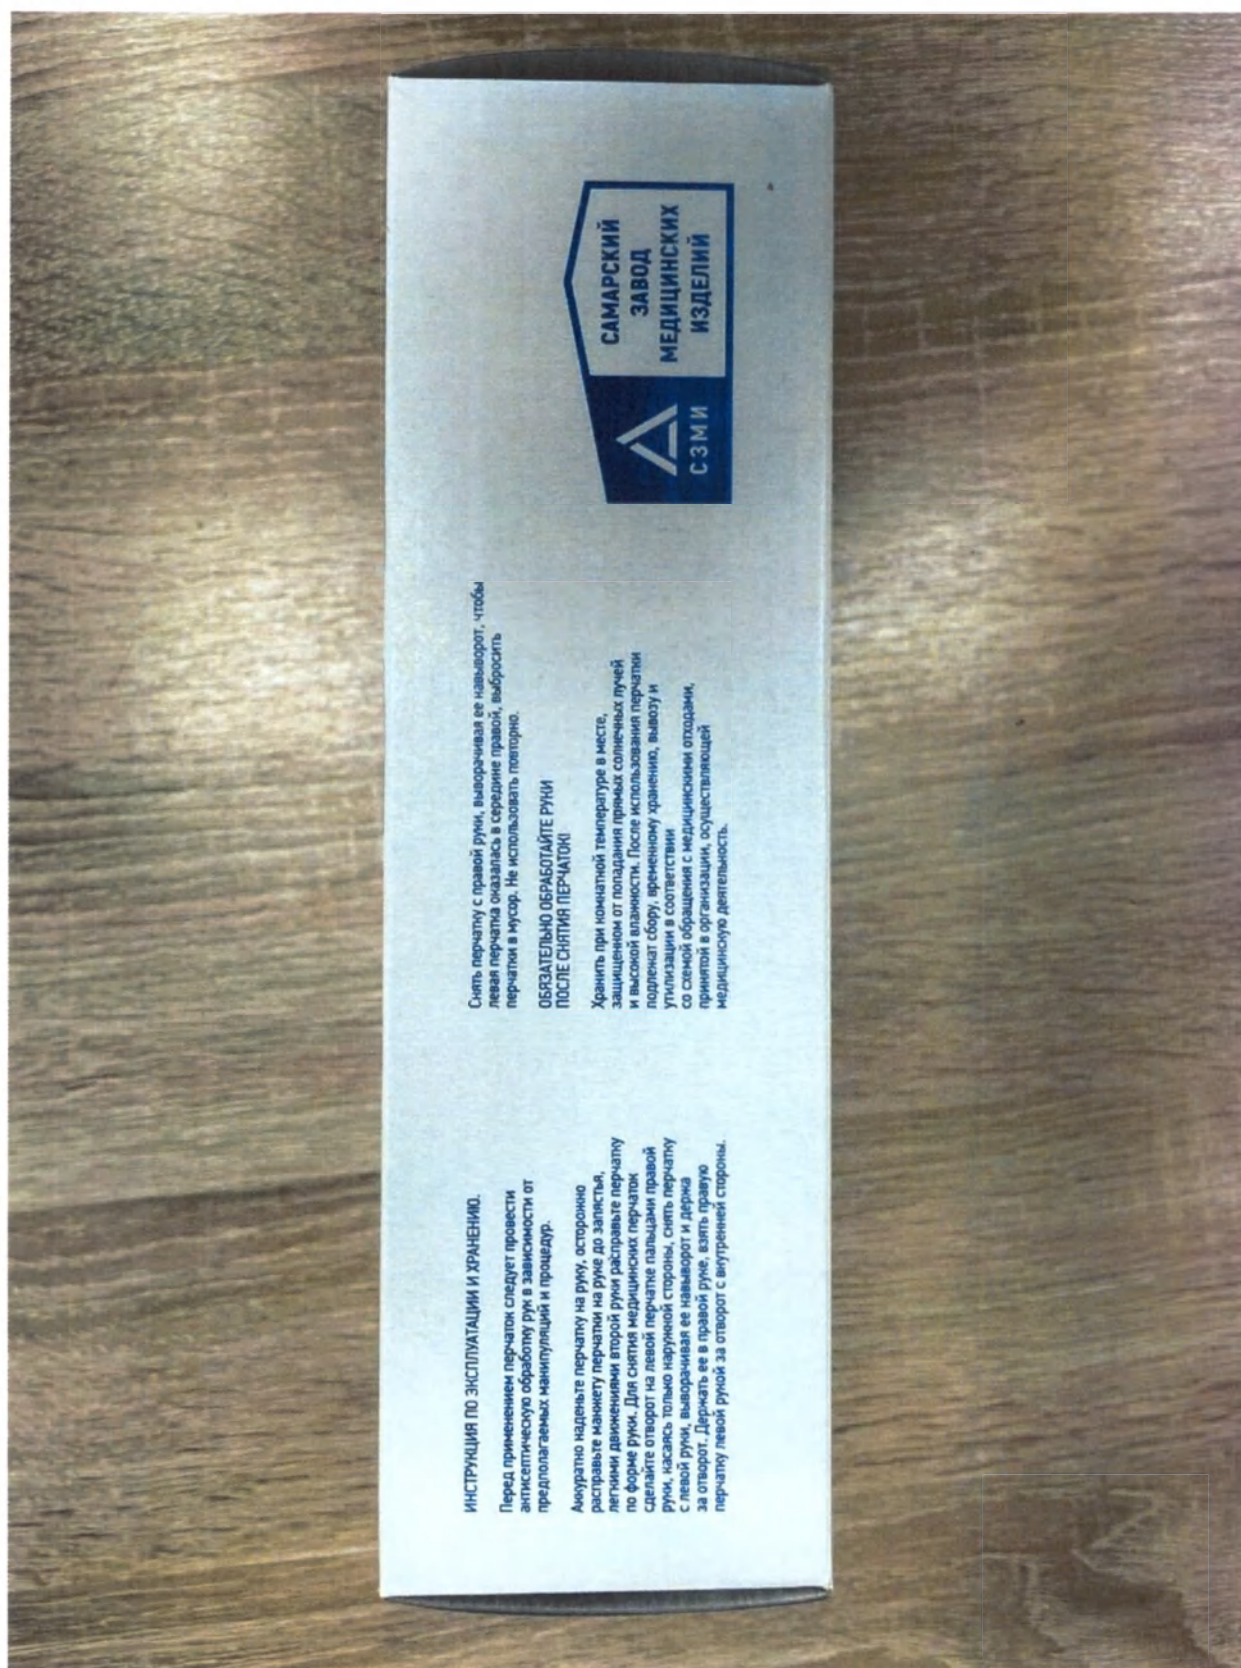


Рисунок 33 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.

Индивидуальная упаковка 50 пар (245x135x72).

(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



Рисунок 34 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023; цвет: синий, размер: L.
Индивидуальная упаковка 50 пар (245x135x72).
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).

НОМЕР ПАРТИИ		
LOT		
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	
		
ТУ 22.19.60-006-03222899-2023		
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004		
(п 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п.8)		
РУ		
		L 50 LARGE ПАР

Рисунок 35 – Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые, стерильные, анатомические по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023: цвет: синий, размер: L.
Индивидуальная упаковка 50 пар (245х135х72).
(упаковка для размеров XS, S, M, XL идентична упаковке для размера L).



Рисунок 36 – Транспортная упаковка. Пример.

Рисунок 37 – Транспортная упаковка. Пример: 30 упаковок по 5 пар
(для размеров XS, S, M, L, XL идентична).

Способ утилизации: Искользанные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Условия транспортирования: Изделия в транспортной таре транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме неоплаченных отсекан самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов. Вид отправки – контейнерами и малой отправки. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – малый малоподъемный. При транспортировании изделий должно быть предусмотрено защита от попадания пыли и атмосферных осадков, попадания солнечных лучей. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150 (при температуре от -50 °C до +50 °C).

Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия, 445043, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, территория 033 ППТ, 3-я магистраль, здание 8.
Info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43

САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

30 упаковок
по 5 пар
Цвет: Синий

НОМЕР ПАРТИИ
LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ТУ 22.19.60-006-03222899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
(п. 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п. 8)

РУ

NON STERILE
нестерильные

2

☀

☂

🌡

20

📖

LATEX

Рисунок 38 – Транспортная упаковка. Пример: 10 упаковок по 25 пар (для размеров XS, S, M, L, XL идентична).

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчаток подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Условия транспортирования: Изделия в транспортной таре транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме нестационарных отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов». Вид отправки – контейнерами и малой отправкой. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – малой железнодорожной. При транспортировании изделий должно быть предусмотрено защита от попадания пыли и атмосферных осадков, попадания солнечных лучей. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150 (при температуре от - 50 °С до + 50 °С).

Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия, 445043, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, территория ОЗЗ ППТ, 3-я магистраль, здание 8.
info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43



10 упаковок
по 25 пар
Цвет: Синий

НОМЕР ПАРТИИ

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

(п. 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п. 8)

РУ



Рисунок 39 – Транспортная упаковка. Пример: 10 упаковок по 50 пар (для размеров XS, S, M, L, XL идентична).

Способ утилизации: Искольженные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213884-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213884-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со своей обращению с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Условия транспортирования: Изделия в транспортной таре транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме нестационарных опорных элементов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов». Вид отправки – контейнерная и малая отправка. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – малый малотоннажный. При транспортировании изделий должно быть предусмотрено защита от попадания пыли и атмосферных осадков, попадания солнечных лучей. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150 (при температуре от -50 °С до +50 °С).

Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия, 445043, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, территория 033 ППТ, 3-я магистраль, здание 8.
info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43



10 упаковок
по 50 пар
Цвет: Синий

НОМЕР ПАРТИИ

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО



ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

(п. 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п. 8)

РУ



Рисунок 40 – Транспортная упаковка. Пример: 6 упаковок по 100 пар (для размеров XS, S, M, L, XL идентична).

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования изделия подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Условия транспортирования: Изделия в транспортной таре транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме неоплаченных отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов. Вид отправки – контейнерная и мелкая отправка. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий железнодорожный. При транспортировании изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков, попадания солнечных лучей. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150 (при температуре от -50 °C до +50 °C).

Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия, 445043, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, территория 033 ППТ, 3-я магистраль, здание 8.
info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43

САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СЗМИ

6 упаковок
по 100 пар
Цвет: Синий

НОМЕР ПАРТИИ
LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ТУ 22.19.60-006-03222899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
(п. 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п. 8)

РУ

NON STERILE
нестерильные

2

☀

☂

🌡

20

i

LATEX

Рисунок 41 – Транспортная упаковка. Пример: 6 упаковок по 50 пар (для размеров XS, S, M, L, XL идентична).

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в период, предусмотренный СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в период, предусмотренный СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Условия транспортирования: Изделия в транспортной таре транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме неоплачиваемых отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов. Вид отправки – контейнерная и навалка отправки». При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – навалка малотоннажный. При транспортировании изделий должно быть предусмотрено защита от попадания пыли и атмосферных осадков, попадания солнечных лучей. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150 (при температуре от -50 °C до +50 °C).

Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия, 445043, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, территория 033 ППТ, 3-я магистраль, здание 8.
info@samzmi.ru
 8 (8482) 70-40-43

САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

СЗМИ

6 упаковок
по 50 пар
Цвет: Синий

НОМЕР ПАРТИИ
 LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ТУ 22.19.60-006-03222899-2023
 Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
 (п. 6.1 (в части определения ширины, длины), п. 6.2, п. 8)

РУ

NON
STERILE
нестерильные

2

☀

☂

🔧

20

i

LATEX



Рисунок 42 – Общий вид транспортной упаковки. Пример

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 43 (сорок три) листа 7
Директор
ООО «СЗМИ»



Земсков А. В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «СЗМИ»


Земсков А.В.

«16» *сентября* 20*24* г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

**Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах,
неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические
по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023**





 
 ИСПОЛЗОВАТЬ ДО ДАТА НЕГОТОВЛЕНИЯ

TY 22 19 60-006-03222899-2023
Cooteetcyet T OCT P 52239-2004

py

ООО «СЗМИ»
 Ор. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия,
 445043, Самарская область, городской округ Тольятти,
 перекресток 033 ППТ, 3-я магистраль, здание 8

info@samzmi.ru
8 (8482) 70-60-63



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАТОМИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 22.19.60-006-03222899-2023



M
MIDDLE

5
ПАР
Ціот персмачак: сині



УДК678.01+678.02 Аккумуляционные насосы-дозаторы
вспомогательных жидкостей / Ю.А.Савин, А.В.Попов, В.И.
Борисов // Проблемы и перспективы развития химической
технологии в машиностроении. - М.: Издательство «Машино-
строение», 2009. - С. 138-141.

Для исследования медицинских исследований, для того или пациентов и транзитивных процедур, использована в качестве защиты с барьера на руках медицинский работник во время осмотра пациента или для других санитарных целей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

применяются следующие показатели:

[illegible]

Состав:
нитрильный патекс (нитрил)

Суть пиринга (своего рода «интернета» для компаний) состоит в том, чтобы не переплачивать за услуги посредников, а выстраивать цепочку поставщиков и покупателей напрямую. Не исключено, что пиринг может стать основой для создания новых рынков.

ОБРАТЕНЬКО УПАДОВАТЕ ПУКИ
ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕРАТОН

Краткий тематический обзор по теме, дающий представление о состоянии проблемы и высокой важности. После изложения первых признаков, симптомов, жалоб, анамнеза, лабораторной и инструментальной диагностики, в заключение приводятся рекомендации по лечению и профилактике в соответствии со сложившимся мнением специалистов, а также с медицинскими стандартами, принятыми в организации осуществляющей медицинскую деятельность.

X-S
S
M
L
X-L



НОМЕР ПАРТИИ
LOT
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИСПОЛЗОВАТЬ ДО



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 22.19.60-006-03222899-2023



XL
EXTRA
LARGE

5
ПАР

ЦВЕТ ПЕРЧАТОК: СИНИЙ



ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

Соответствует ГОСТ Р 52239-2014

(в 6.1.8 части 1 правил обращения медицинских изделий, действующих с 01.01.2018 г.)

РУ

ООО «СЗМИ»
Юр. адрес: место производства: ООО «СЗМИ», Россия,
445443, Самарская область, городской округ Тольятти,
территория ОЗЗ ППТ, 3-я магистраль, здание 8

info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43

Описание и назначение. Использование по назначению и условиям применения в соответствии с инструкцией производителя. Не использовать для других целей, не использовать для стерилизации, не использовать для хранения, не использовать для транспортировки, не использовать для утилизации.

Для проведения медицинских исследований, диагностики заболеваний и травматических повреждений, использования в качестве защитного барьера на руках медицинских работников во время осмотра/лечения пациента или для других медицинских целей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
Перед применением перчатки следует провести антисептическую обработку рук в соответствии с требованиями производителя и вымыть руки с мылом.

Аналогично извлечь перчатку на руку, осторожно, не касаясь внутренней поверхности перчатки, вынуть перчатку из упаковки. Для снятия перчатки с руки, захватить пальцы на внутренней поверхности перчатки, не касаясь внешней поверхности, и снять перчатку за створку. Провести те же действия с другой перчаткой.

Снять перчатку с руки, не касаясь внешней поверхности перчатки, и утилизировать в соответствии с требованиями производителя. Не использовать повторно.

ПОСЛЕ СНИЯТИЯ ПЕРЧАТОК

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подвергать стирке в соответствии с требованиями производителя. Утилизировать в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



Состав:
нитрильный латекс (нитрил)

X-S
S
M
L
X-L



НОМЕР ПАРТИИ
LOT
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 22.19.60-006-03222899-2023



XS
EXTRA
SMALL

5
ПАР



ТУ 22.19.60-006-03222899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
(в 6.1 п. часть требований стандарта, пункты 8.2, 8.3)
РУ

ООО «СЗМИ»
Юр. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Фрязин,
440443, Самарская область, городской округ Тольятти,
территория ОЗС ППТ, 3-я магистраль, здание 8
info@samzmi.ru
8 (8482) 70-40-43

Средств индивидуальной защиты, используемых по назначению в условиях
эпидемиологии в порядке, предусмотренном СанПиН
2.1.3686.21 для медицинских отходов класса Б,
не используются, не являются предметом
использования в порядке, предусмотренном СанПиН
2.1.3686.21 для медицинских отходов класса А. Уникальные
идентификационные коды, присвоенные в соответствии с нормами
и требованиями, действующими в Российской Федерации
на момент производства.

Для производства медицинских изделий, предназначенных для диагностики и
терапевтических процедур, используются в качестве защитного барьера на руках
медицинской персонала во время осуществления манипуляций для других
сменников. Перчатки.

Снять перчатки с правой руки, вывернув наружу ладонь, чтобы
ладонь перчатки оказалась в середине тыльной выворотной
перчатки в левую. Не использовать повторно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: РИНИ
ПОСЛЕ СНИЯТИЯ ПЕРЧАТОК

Хранить при комнатной температуре в месте,
удаленном от попадания прямых солнечных лучей
и высокой влажности. После использования перчатки
подвергать сбору, вымыванию ладонью, запястьем и
утилизировать в соответствии со схемой обращения
с медицинскими отходами, принятой в организации,
осуществляющей медицинскую деятельность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Перед применением перчатки следует провести
индивидуальную обработку рук в соответствии с
протоколом гигиены и профилактики инфекции.
Аналогично извлечь перчатку на левую руку, осторожно
свернуть ладонь перчатки на руке до запястья,
всех пальцев и кисти. Для снятия медицинских перчаток
сделать оборот на ладонь перчаточной ладони правой
руки, сделать только несущую сторону, снять перчатку
с левой руки, вывернув наружу ладонь, чтобы
ладонь перчатки оказалась в середине тыльной выворотной
перчатки в левую руку. Не использовать повторно.



Состав:
нитрильный латекс (нитрил)

X-S
S
M
L
X-L



С 25
ПАР
SMALL

info@samzdr.ru
8 (8482) 70-40-43

ООО «СЗМИ»
Адрес: место производства: ООО «СЗМИ», Россия,
445043, Самарская область, городская округ Тольятти,
перекресток 033 ППТ, 3-й микрорайон, здание 6

ПЕРЧАТКИ

С 25
ПАР
SMALL



САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

С 25
ПАР
SMALL

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
по ТУ 22.19.60-006-05222899-2023

25
ПАР



С 25
ПАР
SMALL

КОДЫ: LOT, DATE, EXPIRATION
ИСТОЧНИК: ДО
ИСТОЧНИК: ДО
ТУ 22.19.60-006-05222899-2023
Согласно ГОСТ Р 52238-2004
на 3-й микрорайон, здание 6, п. 6.1.1.8)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПАКОВКЕ

Перед применением перчатки следует проверить
анатомическую форму на руке в соответствии с
предназначением, назначением и размером.

Анализировать качество перчаток на руке, используя
различные материалы перчаток на руке до заделки,
поэтому двусторонний способ заделки перчаток
по форме руки. Для этого медицинскими перчатками
СЗМИ следует на левую руку надевать перчатку
руки, на правую руку надевать перчатку
с левую руку, вывернувшись из накладки и делая
за складку. Проверить не в правой руке, а в левой,
перчатку, а не в правой руке, а в левой, перчатку,
а не в правой руке, а в левой, перчатку, а не в правой

Снять перчатку с правой руки, вывернув ее наизнанку, чтобы
внутренняя поверхность перчатки была чистой, вывернуть
перчатку в левую руку. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Содержите перчатки в чистоте, храните их в месте,
удаленном от попадания прямых солнечных лучей
и высокой влажности. После использования перчатки
подвергните сбору, дезинфекции, хранению, выстирке и
стирке в соответствии
с инструкцией по применению. Медицинские перчатки
применяются в соответствии с инструкцией по применению
медицинских перчаток.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Данное изделие предназначено для использования в
медицинской практике, для защиты пациента и
медицинского работника от заражения и передачи
инфекции.



25
ПАР

С 25
ПАР
SMALL

Цвет перчаток: белый
Состав: нитрилбутадиен-латекс (НБЛ)

Свойства: перчатки изготовлены из прочного, эластичного
материала, который обеспечивает надежную защиту
пациента и медицинского работника от заражения
инфекцией. Перчатки имеют текстурированную
поверхность, которая обеспечивает надежное
удержание. Перчатки соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52238-2004 для медицинских перчаток.
Перчатки не содержат латекса, поэтому они
подходят для использования людьми с аллергией
на латекс.



10



XS
EXTRA
25
PAR

Ид. адрес, место производства: ООО «СЗМИ», Россия,
445043, Самарская область, городское округ Тольятти,
перекресток 033 ППТ, 3-й микрорайон, здание 8
info@szmi.ru
8 (8482) 70-40-43

ПЕРЧАТКИ
XS 25
EXTRA
PAR
SMALL



Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением:

XS ПЕРЧАТКИ
ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 22.19.60-006-05222899-2023

25
PAR

XS 25
EXTRA
PAR
SMALL

КОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИСТОЛЬЗОВАТЬ ДО

ТУ 22.19.60-006-05222899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52235-2004
(1+6 1+8 401+6) (внутренний шов, ладонь) 1+6 2+8

ПВ

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Перед применением перчатки следует провести антисептизацию обработанной руки в соответствии с прилагаемыми рекомендациями и процедурами.

Акуратно надеть перчатку на руку, осторожно расправить манжету перчатки на руке до запястья, легким движением вперед руки расправить перчатку по форме руки. Для лучшего медицинского сцепления следует отвести на ладонь перчатку, при этом правую руку держать только наружной поверхностью, левую перчатку с левой руки, вывернув ее наружу и держа за манжету. Держать ее в правой руке, ладонь правой перчатки второй рукой изнутри и внешней стороны.

Снять перчатку с правой руки, вывернув ее наружу, чтобы ладонь перчатки оказалась в середине ладони, выбросить перчатку в мусор. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ РУКИ ПОД СТРОГОМ ПОДРОЗОМ

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки поднимать сразу, аккуратно, избегая контакта с поверхностью и соответствия. Со строгим обращением с медицинскими отходами, применять в соответствии с инструкциями медицинского персонала.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ



25
PAR

XS
EXTRA
SMALL

Цвета перчаток: синий

Состав: нитриловый латекс (натуральный)

Свойства: прочные, устойчивые к порезам, имеют упругие свойства, не вызывают аллергии. Соответствует требованиям к медицинским перчаткам по ГОСТ Р 52235-2004. Соответствует требованиям к медицинским перчаткам по ГОСТ Р 52235-2004. Соответствует требованиям к медицинским перчаткам по ГОСТ Р 52235-2004.



XS 25 PAR





L 50
LARGE
ПАР

info@sazmi.ru
8 (8482) 70-40-43
445043 Самарская область, городской округ Тольятти
г. Тольятти, мкр. Южная, д. 100
Юр. адрес: место производства ООО «СЗМИ», Россия

ПЕРЧАТКИ

L 50
LARGE
ПАР



САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

ПЕРЧАТКИ

L 50
LARGE

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

50
ПАР



L 50
LARGE
ПАР

НОМЕР ПАРТИИ
ЛОТ
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО
ТУ 22.19.60-006-03222899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
ГОСТ Р 52239-2004
РУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Перед применением перчатки следует проверить на отсутствие повреждений и целостности от предельных температур и влажности.

Аккуратно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. По линии движения второй руки расправьте перчатку по форме руки. Для снятия медицинских перчаток: сначала оторвите на левой перчатке пальчики правой руки, касаясь только наружной стороны, снимите перчатку с левой руки, выворачивая ее наизуток и делая из отворота. Держите ее в правой руке, жалея правую перчатку правой рукой из отворота с внутренней стороны.

Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизуток, чтобы левая перчатка вывернулась и оказалась чистой. Выбросить перчатку в мусор. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕЗВРЕЖИВАЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ СНИЯТИЯ ПЕРЧАТОК!

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчатки подержать в бумажном контейнере, вынуть и утилизировать в соответствии со стандартами, связанными с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НИТРИЛОВЫЕ,
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ, НЕОПУДРЕННЫЕ,
ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Для проверки качества: потяните за пальчики, перчатки и проверьте на отсутствие повреждений и целостности от предельных температур и влажности.



50
ПАР

L 50
LARGE

Цвет перчаток: синий

После использования перчатки (важно!)

После использования перчатки (важно!) следует немедленно и аккуратно оторвать перчатки от руки, выворачивая их наизуток, чтобы левая перчатка вывернулась и оказалась чистой. Выбросить перчатку в мусор. Не использовать повторно.



ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

ООО «СМН»
 ОП апсес, место про-
 445043 Самарская обл.
 терпортной ОЗЗ ППТ, 3-й
 info@samzml.ru
 8 (8482) 70-40-43

ПЕРЧАТКИ



**САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ**

MIDDLE 50 TAP

M
MIDDLE

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ по ТУ 22.19.50-006-03222899-2023

50
ПАР



M50
MIDDLE EAST
CAP

НОМЕР ПАРТИИ

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

TU 22 19 60-006 33227899, 2023

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

с 15 марта 2024 года по 15 апреля 2025 года, Длительность хранения: 12 мес.

PV

ANALYSED BY: THE NATIONAL INSTITUTE FOR

Перед применением Тарчтон следует провести антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций и процедур.

Двуручно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья, так как длинноватый второй рука расправляет перчатку по форме руки. Для снятия медицинский перчаток сделайте отверстие на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны, снять перчатку с левой руки, выворачивая ее манжетой и держа за отверстие. Держать ее в правой руке, снять правую перчатку левой рукой за отверстие с внутренней стороны.

Сдать перчатку с правой руки, выходящую из калитки, чтобы
такая перчатка оказалась в середине (одевая, выходя из
перчатки в мутор. Не использовать повторно)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПЕРЧАТКА

[illegible]

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ, НЕОПУДРЕННЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

[illegible]

50
ПАР

M
MIDDLE

[Ligand 6: 1,2-bis\(4-phenylphenyl\)ethane](#) (1.000 g, 2.500 mmol)

Curtag: workshop on national identity

Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют данные относительно того, насколько широко распространены в Украине случаи нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. По мнению автора, это связано с тем, что в Украине отсутствуют государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об интеллектуальной собственности.

000 «СММ»
Юр. аспект. Место по-
ложения 445043 Самарская обл.
Территория 033 7711.3-8
info@samzml.ru
8 (8482) 70 40 43

ПЕРЧАТКИ



**САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ**

S **50**
SMALL PAF

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением:

S
SMALL

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023

50
ПАР

S 50 PAP



COMED NADPAM

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

TV 22 19 60-006-03227899-7023

СООБЩЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ П. 52239-2004

Fig. 1. (a) - surface roughness, R_a (nm); (b) - R_q (nm).

ру

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Перед применением перчаток следует провести антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций и процедур.

Аккуратно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Легкими движениями второй руки расправьте перчатку по форме руки. Для снятия медицинских перчаток сделайте отверстие на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только надувной стороны, снимя перчатку с левой руки, выворачивая ее наизыснут и держа за отверстие. Держать ее в правой руке, взять правую перчатку левой рукой за отверстие с изнушенной стороны.

Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизуток, чтобы левая перчатка оказалась в середине правой, вывернуть левую перчатку в мусор. Но использовать повторно.

INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE CHANGE
 POLICY AND RESEARCH

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования герметично закрыть крышку, временно не использовать, высушить и хранить в сухом месте.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ,
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ, НЕОПУДРЕННЫЕ,
ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

[illegible]

Цвет перилетом синий

Состав: нитрильный латекс (нитрил)

Целью исследования является выявление по названию изделий для молодежи в период, предшествующий 1917 г. (табл. 1) для нехудожественной одежды класса Б, то есть изготовление нехудожественной одежды и изделий с декоративными элементами подосновы, с минимальной стилизацией элементов, в период, предшествующий 1917 г. (табл. 2) для нехудожественной одежды класса А. Упомянутые изделия должны противопоставляться в составе или в названии и в рисунке, отличием в Российской Федерации и в импортных странах.



000 «СМН»
Ор. адрес: Место прох
445043 Самарская обл
Территория 033 ПИТ.3-В
info@samzml.ru
8 (8482) 70-40-43

ПЕРЧАТКИ

XL 50
EXTRA
LARGE
TAP



**САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ**

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

XL
EXTRA
LARGE

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ по ТУ 22.19.60-006-0322899-2023

50
ПАР

XL 50
EXTRA
LARGE



НОМЕР ПАРТИИ []
[] LOT [] ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО []
[] DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ []
TV 22 19 60-006-03272899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004
(IEC 60335-1) и требованиям стандарта ДСТУ EN 60335-1

ИНТЕРФУНКЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И АГРАРИЙНОЕ

Перед применением паричтов следует провести антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций и процедур.

Аккуратно надвиньте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья, легким движением второй руки расправьте перчатку по форме руки. Для снятия медицинских перчаток, сделайте опорот на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны. Снимите перчатку с левой руки, выворачивая ее наизуток и держа за опорот. Держите ее в правой руке, в это время перчатку левой рукой за опорот с вращением стороны

Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизувет, чтобы левая перчатка оказалась в середине правой, вывернуть перчатку в мусор. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ
ПОСЛЕ СНИЯТИЯ ПЕРЧАТКИ

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования перчаток подложить лоскут, пропитанный раствором, вату или впитывающие салфетки.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ, НЕОПУДРЕННЫЕ,
ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, НЕАТОМИЧЕСКИЕ:

Дана информация не является официальной и не должна использоваться для принятия каких-либо решений. Она предоставляется исключительно в информационных целях.



50
ПАР

XL
EXTRA
LARGE

Цвет перчаток: синий

Состав: нитрильный латекс (нитрил)

Способ утилизации. Исходящими по назначению изделия (или изделия) из отходов, предусмотренных Законом № 3863-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, а также изделия «эквивалент» (структурный) в порядке, предусмотренном Законом № 3863-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с требованиями и процедурами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.



16

E7-07-04 (Z878) 8
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2010 BY 60322
UCBAW/STP/STP

[illegible]

ПЕРЧАТКИ M 50
MIDDLE TAP

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

ПЕРЧАТКИ

M
MIDDLE

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.18.60-006-032.22.899-2023

50
ПАР



MIDDLE

50 PAP

ОМЕР ПАРТИИ: []
 LOT: []
 DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: [] ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО: []
 Y 22 19.60.006-0322889-2023
 соотвествует ГОСТ Р 52239-2004
 6) в части определения содержания диоксида (п. 2.2 п.8)

2007年12月15日 星期一 12:15

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est considérée comme illicite. Elle sera poursuivie judiciairement à l'encontre des contrevenants.

Тяжеломери надземные (переносные) на ручке, оборудованы устройством измерения расстояния над ручкой до дна емкости. Работают с помощью датчиков инфракрасного излучения. Наименьшая глубина ручек. Для измерения температуры переносные тяжеломеры оторваны на линии переноса, запястьями правой руки. Настройка прибора «кадрирование» стороны. Снять переноску с линии ручек, выключившись от аккумулятора и держа на отпорте. Зажимать в правой руке, чтобы избежать повреждения линии ручки. Запрещается использовать тяжелые инструменты.

Синтез термоду с правой руки, выверенный на выводе, чтобы
первый термоду был равен нулю, выразить
термоду с правой руки, выверенный на выводе, чтобы

OXIDATION OF GLUCAMINE FROM
OCTOBER 1985 TO DECEMBER 1985

[illegible]

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕБАТОВЫЕ

Этот процесс имеет место в отношении всех видов растений и животных, поэтому не имеет смысла говорить о том, что в отношении одних из них он происходит быстрее, чем в отношении других.



50
PAR
M
MIDDLE

[Visit our website](#)

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at 10:00 10 May 2015

[illegible]



S 50
PAR
SMALL

8 (8482) 70-60-43
info@sazmi.ru

ООО «СЗМИ», место нахождения: 440000, Самарская область, г. Самара, ул. Бухаркина, 8
440000, Самарская область, г. Самара, ул. Бухаркина, 8



ПЕРЧАТКИ
S 50
PAR
SMALL

САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением:

ПЕРЧАТКИ

S
SMALL

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
по ТУ 22.19.06-006-03222895-2023

50
PAR



S 50
PAR
SMALL

НОМЕР ПАКЕТА:
LCT
ДАТА УДОБРОУСТРОЕНИЯ: 01.03.2024
Срок годности: 36 мес.
ТУ 22.19.06-006-03222895-2023
Согласно ТУ 22.19.06-006-03222895-2023
П. 1.8. для медицинских изделий, изделий из латекса

Упаковка изделия: 50 пар в коробе (100 пар в коробе)

Пары перчаток упакованы в короб, который не
подвержен воздействию влаги, воздуха, пыли,
при этом изделие находится в стерильном состоянии

Изделие изготовлено из нитрила, который
является искусственным полимером на основе
дициановых соединений. Изделие имеет
форму перчатки. Для удобства использования
изделие имеет текстурирование на пальцах.
Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.
Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.

Изделие изготовлено из нитрила, который
является искусственным полимером на основе
дициановых соединений. Изделие имеет
форму перчатки. Для удобства использования
изделие имеет текстурирование на пальцах.
Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.

Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.
Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Для применения изделия необходимо:
1. Проверить целостность упаковки.
2. Проверить срок годности.
3. Проверить форму изделия.



50
PAR
S
SMALL

Длина перчатки: 210 мм

Средняя ширина ладони: 90 мм

Изделие изготовлено из нитрила, который
является искусственным полимером на основе
дициановых соединений. Изделие имеет
форму перчатки. Для удобства использования
изделие имеет текстурирование на пальцах.
Изделие имеет форму перчатки, которая
является удобной для использования.





XL 50
EXTRA
LARGE

info@szmi.ru
8 (8482) 70-40-43

ООО «СЗМИ»
465043, Самарская область, г. Самара, район В. Волжский
Кор. АИР-1, литеры А, литера В, корпус 8
Корпус 003 ПП, 3-й этаж, литера В



САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ПЕРЧАТКИ

XL 50
EXTRA
LARGE

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением:

ПЕРЧАТКИ

XL
EXTRA
LARGE

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
по ТУ 22.16.60-006-0522899-2023

50
ПАР



XL 50
EXTRA
LARGE

ИМЕННОЕ ПУЛТИН
ЛОТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ДС
ДАТА ВВОДА
ТУ 22.16.60-006-0522899-2023
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 52239-2004
ИЗД. 1.0 от 01.01.2014

Использовать по назначению.

Перед применением перчатки следует проверить на целостность и отсутствие дефектов (разрывов, порезов).

Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях и на предприятиях, где требуется защита рук от загрязнения и повреждения. Перчатки не предназначены для использования в качестве защиты от биологических жидкостей, химических веществ, острых предметов и высоких температур.

Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях и на предприятиях, где требуется защита рук от загрязнения и повреждения.

Перчатки не предназначены для использования в качестве защиты от биологических жидкостей, химических веществ, острых предметов и высоких температур.

Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях и на предприятиях, где требуется защита рук от загрязнения и повреждения. Перчатки не предназначены для использования в качестве защиты от биологических жидкостей, химических веществ, острых предметов и высоких температур.



САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Для применения перчатки следует проверить на целостность и отсутствие дефектов (разрывов, порезов).

Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях и на предприятиях, где требуется защита рук от загрязнения и повреждения. Перчатки не предназначены для использования в качестве защиты от биологических жидкостей, химических веществ, острых предметов и высоких температур.



50
ПАР
XL
EXTRA
LARGE

Длина перчаток: 21 см.

Длина перчаток: 21 см.

Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях и на предприятиях, где требуется защита рук от загрязнения и повреждения. Перчатки не предназначены для использования в качестве защиты от биологических жидкостей, химических веществ, острых предметов и высоких температур.





XL
EXTRA
100
PAR

info@sazmi.ru
8 (8482) 70-40-63

ООО «СЗМИ» имеет производственный сертификат
№ 14902, Самарской области, выданный
Исполнительным органом власти
Исполнительный орган власти



ПЕРЧАТКИ

XL
EXTRA
100
PAR

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением.

ПЕРЧАТКИ

XL
EXTRA
LARGE

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
АНАТОМИЧЕСКИЕ
по ТУ 22 19 50-006-05222898-2023

100
PAR



XL
EXTRA
100
PAR

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ЛОТ
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТУ 22 19 50-006-05222898-2023
Соответствует ГОСТ Р 52235-2004
(в части маркировки продукции) (в части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки предназначены для защиты кожи от
механических повреждений, а также для
предотвращения загрязнения и травмы.

Перчатки предназначены для защиты кожи от
механических повреждений, а также для
предотвращения загрязнения и травмы.

Перчатки предназначены для защиты кожи от
механических повреждений, а также для
предотвращения загрязнения и травмы.

Перчатки предназначены для защиты кожи от
механических повреждений, а также для
предотвращения загрязнения и травмы.

Перчатки предназначены для защиты кожи от
механических повреждений, а также для
предотвращения загрязнения и травмы.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
АНАТОМИЧЕСКИЕ

Две перчатки, медицинское изделие, предназначенное для
предотвращения травмы, а также для защиты кожи от
механических повреждений, а также для предотвращения
загрязнения кожи.




100
PAR

XL
EXTRA
LARGE

Содержит инструкции по применению

Содержит инструкции по применению

Содержит инструкции по применению



87-07-06 (2878) 8
RJWZMS@OJW

ИП ООО «СМН»
ИП, адрес: место нахождения: ООО «СМН», Россия;
ИП(ОГ), Капсодов Олег, директор ООО «СМН»
ИП(ОГ) 033 001, 3-й этаж, п.п. 3, 4, 5

ПЕРЧАТКИ

L 100
LARGE MAP

L
LARGE

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
по ТУ 22.19.60.006.0322899.2023

100
PAR



LARGE PAP 100

НОМЕР ПАРТИИ []
[LOT] []

ДАТА И ГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО []

[] []

ТУ 22 19.60-006-0322899-2023
Соответствует ГОСТ Р 52739-2004

(в частях выражения полноты, длины, п. 6.2, п. 8)

ру []

Перед применением перчаток следует провести антисептическое обра­ ботку рук в зависимости от показаний к применению и маркировки.

Аккуратно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте мизинец перчатки на руке до запястья. Перчатки, расстегиваемые атласной лентой, расправляют перчатку по форме руки. Для снятия медицинских перчаток: сделайте отверстие на ладони перчатки, нажимая правую руку, касаясь только наружной стороны. Снять перчатку с левой руки: выворачивая ее наизуворот и держа за отворот. Держать ее в правой руке, когда правую перчатку левой рукой за отворот с внутренней стороны.

Снять перчатку с правой руки, вывернув ее наизнанку. Чтобы левая перчатка оказалась в середине правой, выбросить перчатки в мусор. Не использовать повторно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПЕРЫШКА!

Держать при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности. После использования медицинский надзор, сбор, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Данное исследование является первичным исследованием, и поэтому не должно использоваться для принятия каких-либо решений. Результаты исследования могут быть использованы для планирования дальнейших исследований.



100
PAR

L
LARGE

[Open in Google Docs](#)

Согласно утверждению Лаврова (цитируя

Список литературы: 1. Конференция на национальном уровне о завершении и модернизации реформ (См. №1/2/2005/2) для независимых отводов власти и на государственном уровне на национальном уровне и отводах с участием органов власти, с организацией управления, управлением в области правоохранительных Служб, 2. 2005/2/2 для независимых отводов власти. А также на уровне должностных арестов и в отделе отводах с участием органов власти в Российской Федерации на уровне, на уровне.



24

Ид. зап. нет: госархив: 000 -САН-
45402; Классиф. общ.: госархив: 000 -САН-
неопубл. 003 ИИ. 3-й вариант: 000 -САН-
info@san.ru
8 (8492) 70-40-43

**САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ**

ПЕРЧАТКИ XS 100
EXTRA SMALL TAP

XS
EXTRA
SMALL

Название изделия в соответствии
с регистрационным удостоверением

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ,
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАТОМАТИЧЕСКИЕ
по ТУ 22 15 50-005 0322899-2025

100
PAR



XS 100
EXTRA
SMALL
PAP

ЮМЕР ПАРТИИ

ЛОТ

ДАТА И ГОТОВЛЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

УТУ 22 19.60.006-0322899-2023

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 52239-2004

ИЗ 1 (в числе первоприсланных), из 2, 1, 0

пу

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted November 1, 2014. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Посредством системы перемычек, соединяющей элементы конструкции, обеспечивается связь в вертикальном и горизонтальном направлениях и происходит

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Скорость при изменении температуры в материале зависит от его площади, принципа составления, формы и физической величины. Таким образом, изменение температуры зависит от скорости, геометрии, характера нагрузки и т.д. (рис. 1).



САМАРСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НИТРИЛОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НА ПАЛЬЦАХ
НЕОПУДРЕННЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ

Данная работа является частью диссертационного исследования, выполненного в соответствии с программой «Информационные технологии в образовании».



100
ПАР

XS
EXTRA
SMALL

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 26 (двадцать) листов
Директор шесть
ООО «СЗМИ»



Земсков А. В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор


ООО «СЗМИ»


Земсков А.В.


№ 16 » 09.09.2024 г.


МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ


**Перчатки медицинские диагностические нитриловые, текстурированные на пальцах,
неопудренные, одноразовые, нестерильные, неанатомические
по ТУ 22.19.60-006-03222899-2023**

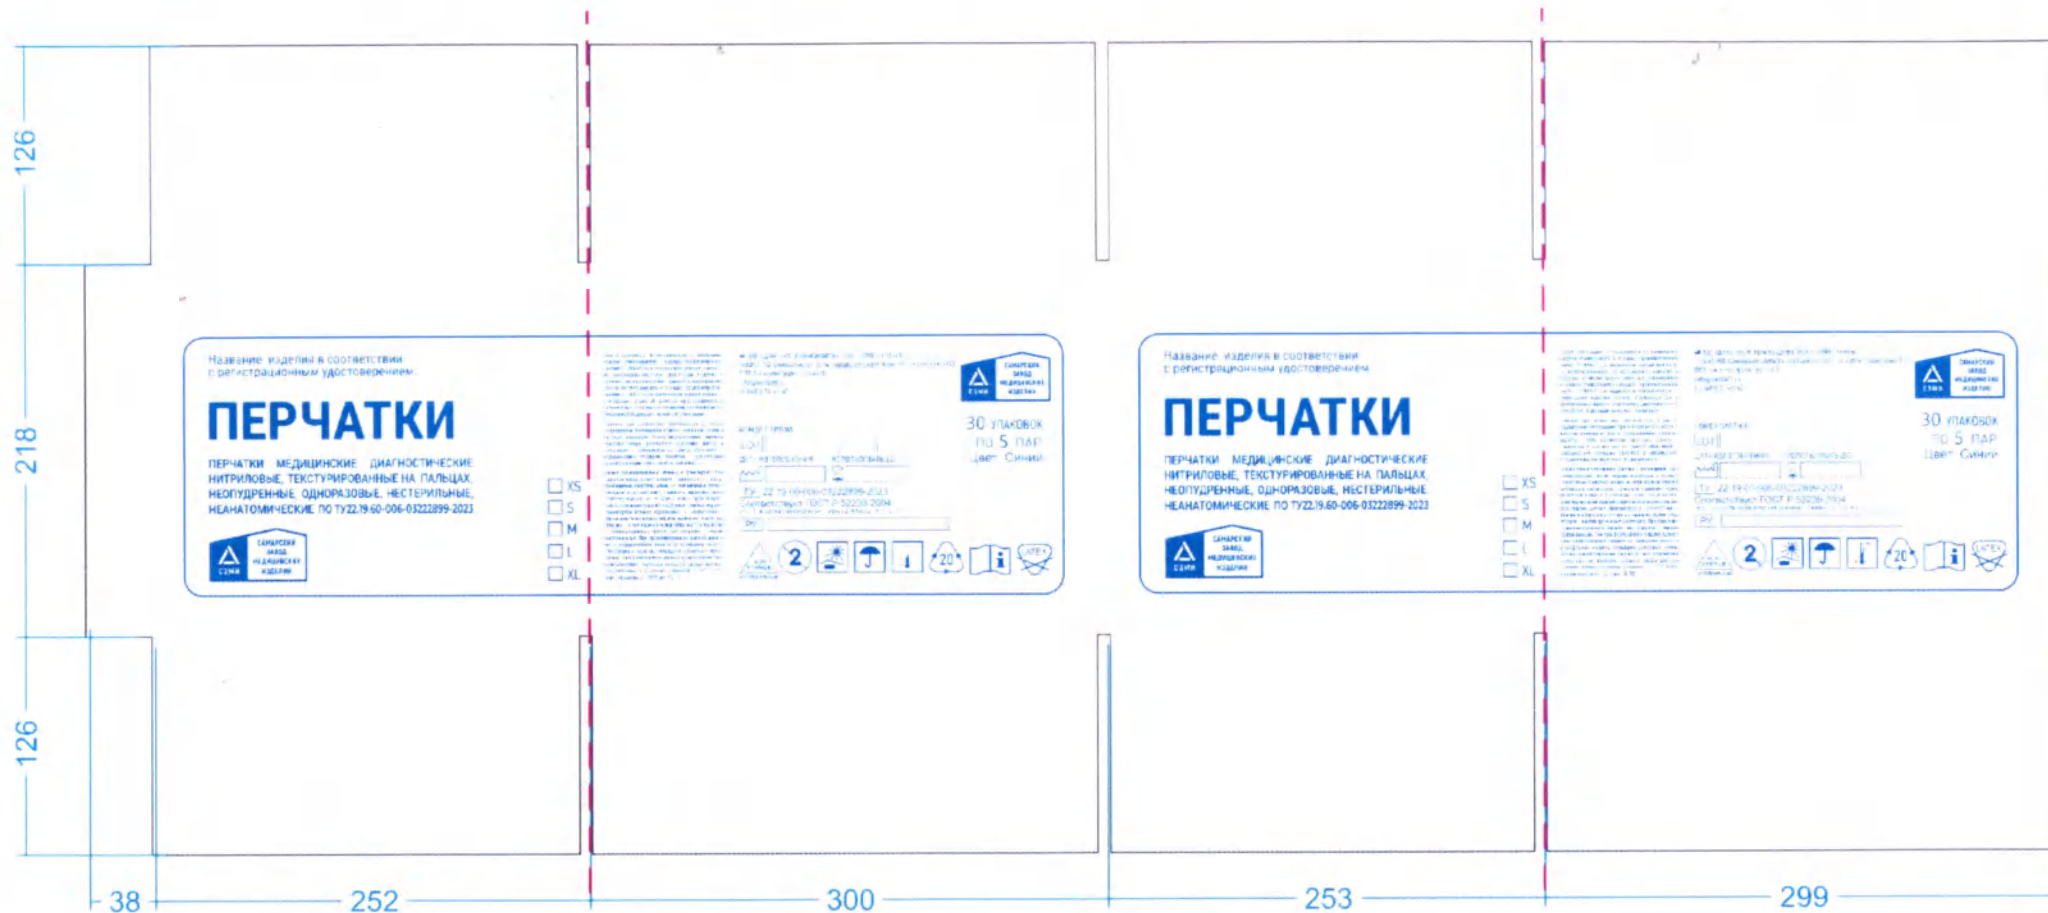

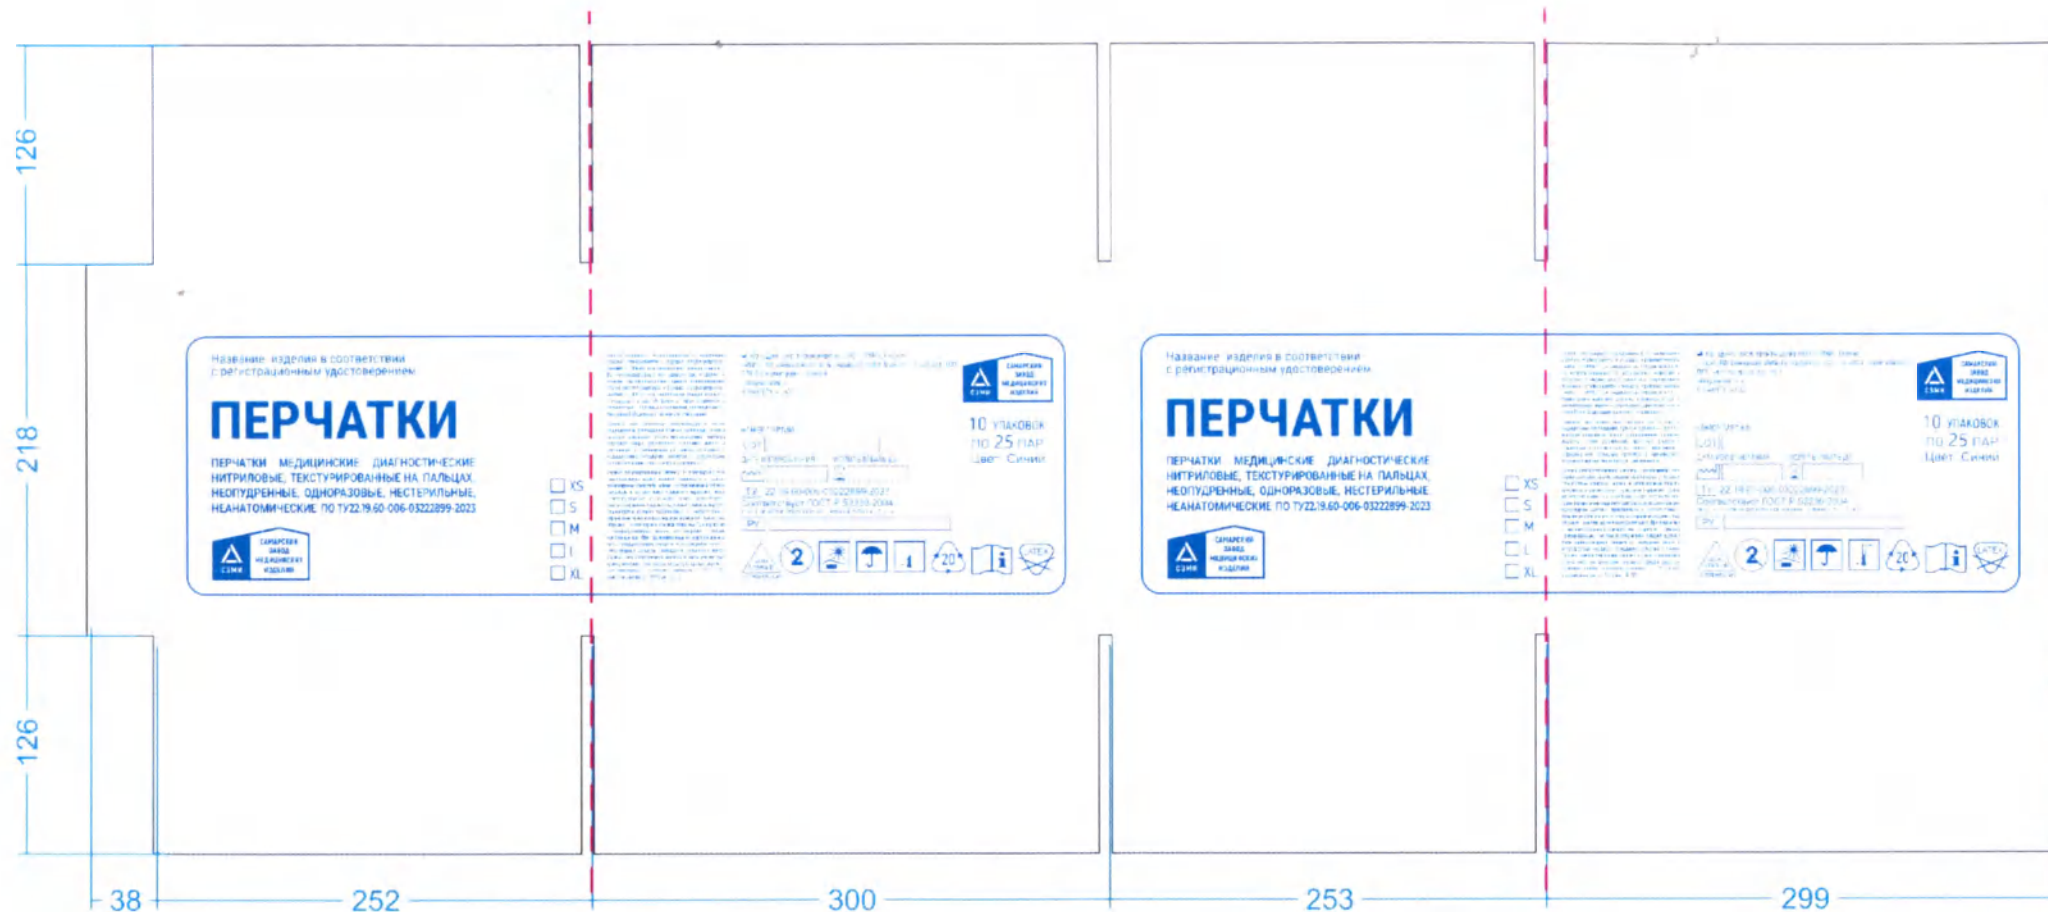

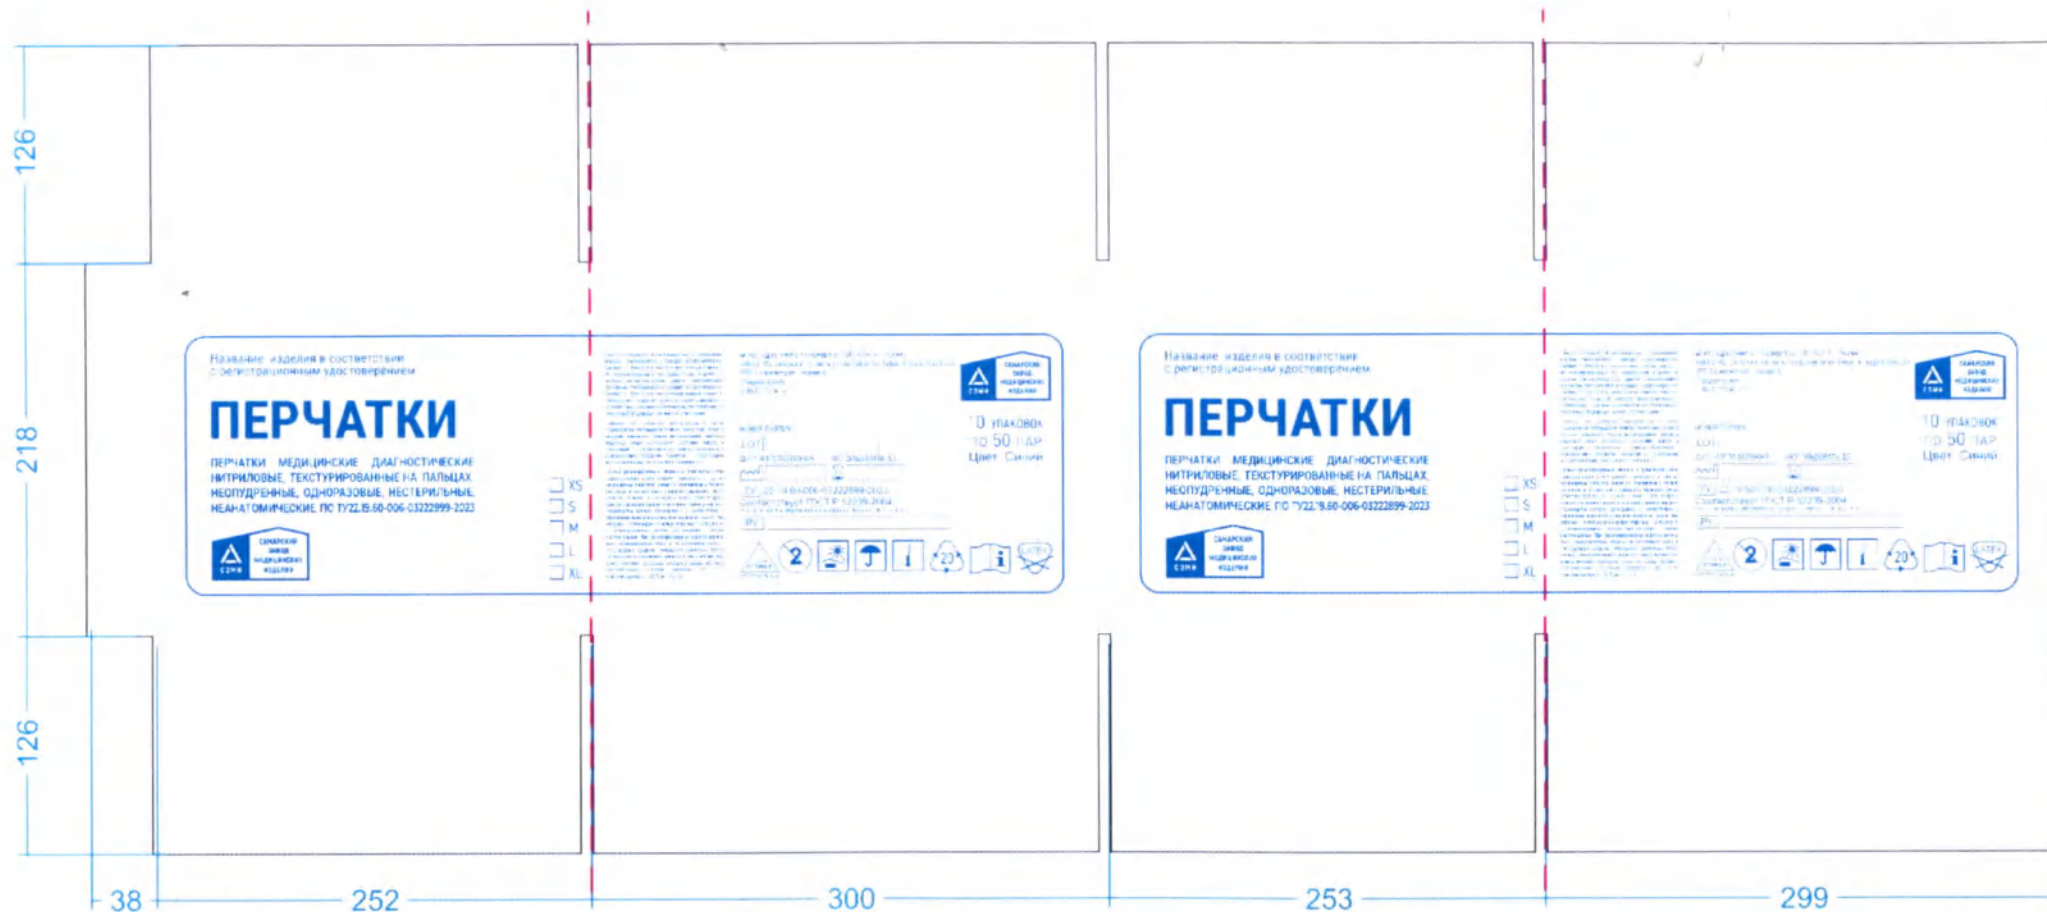

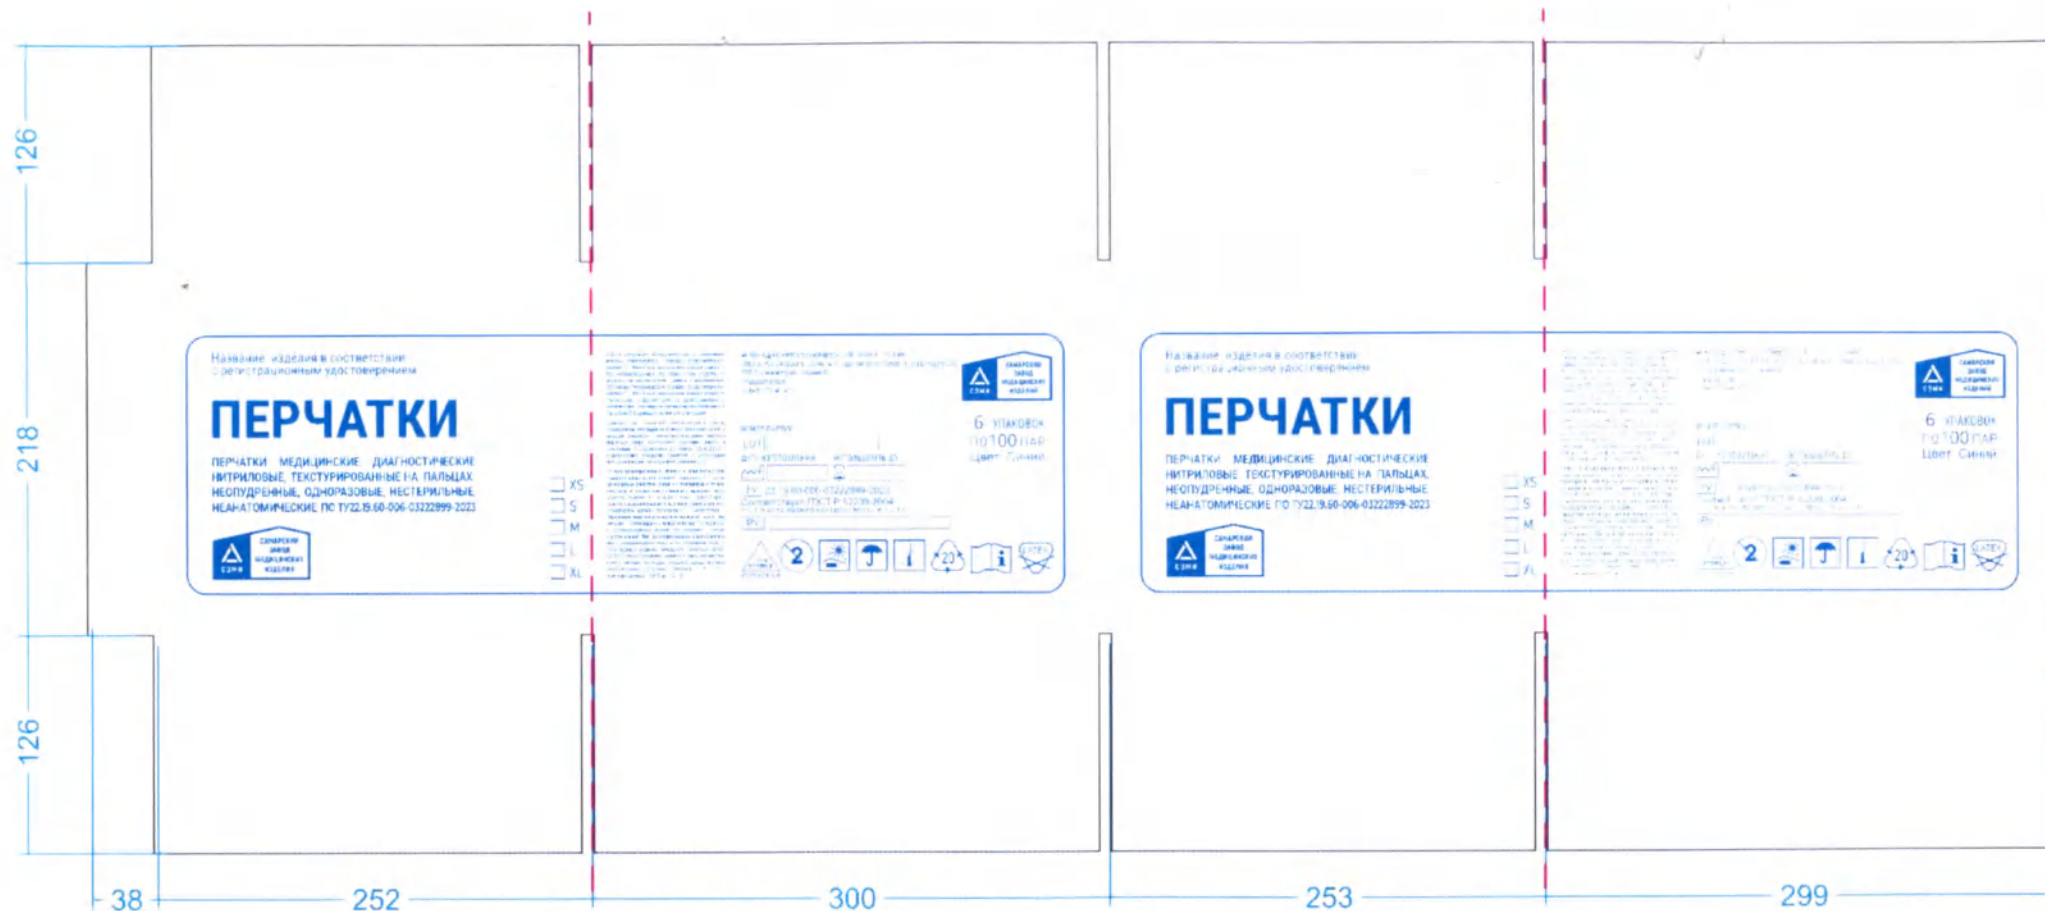

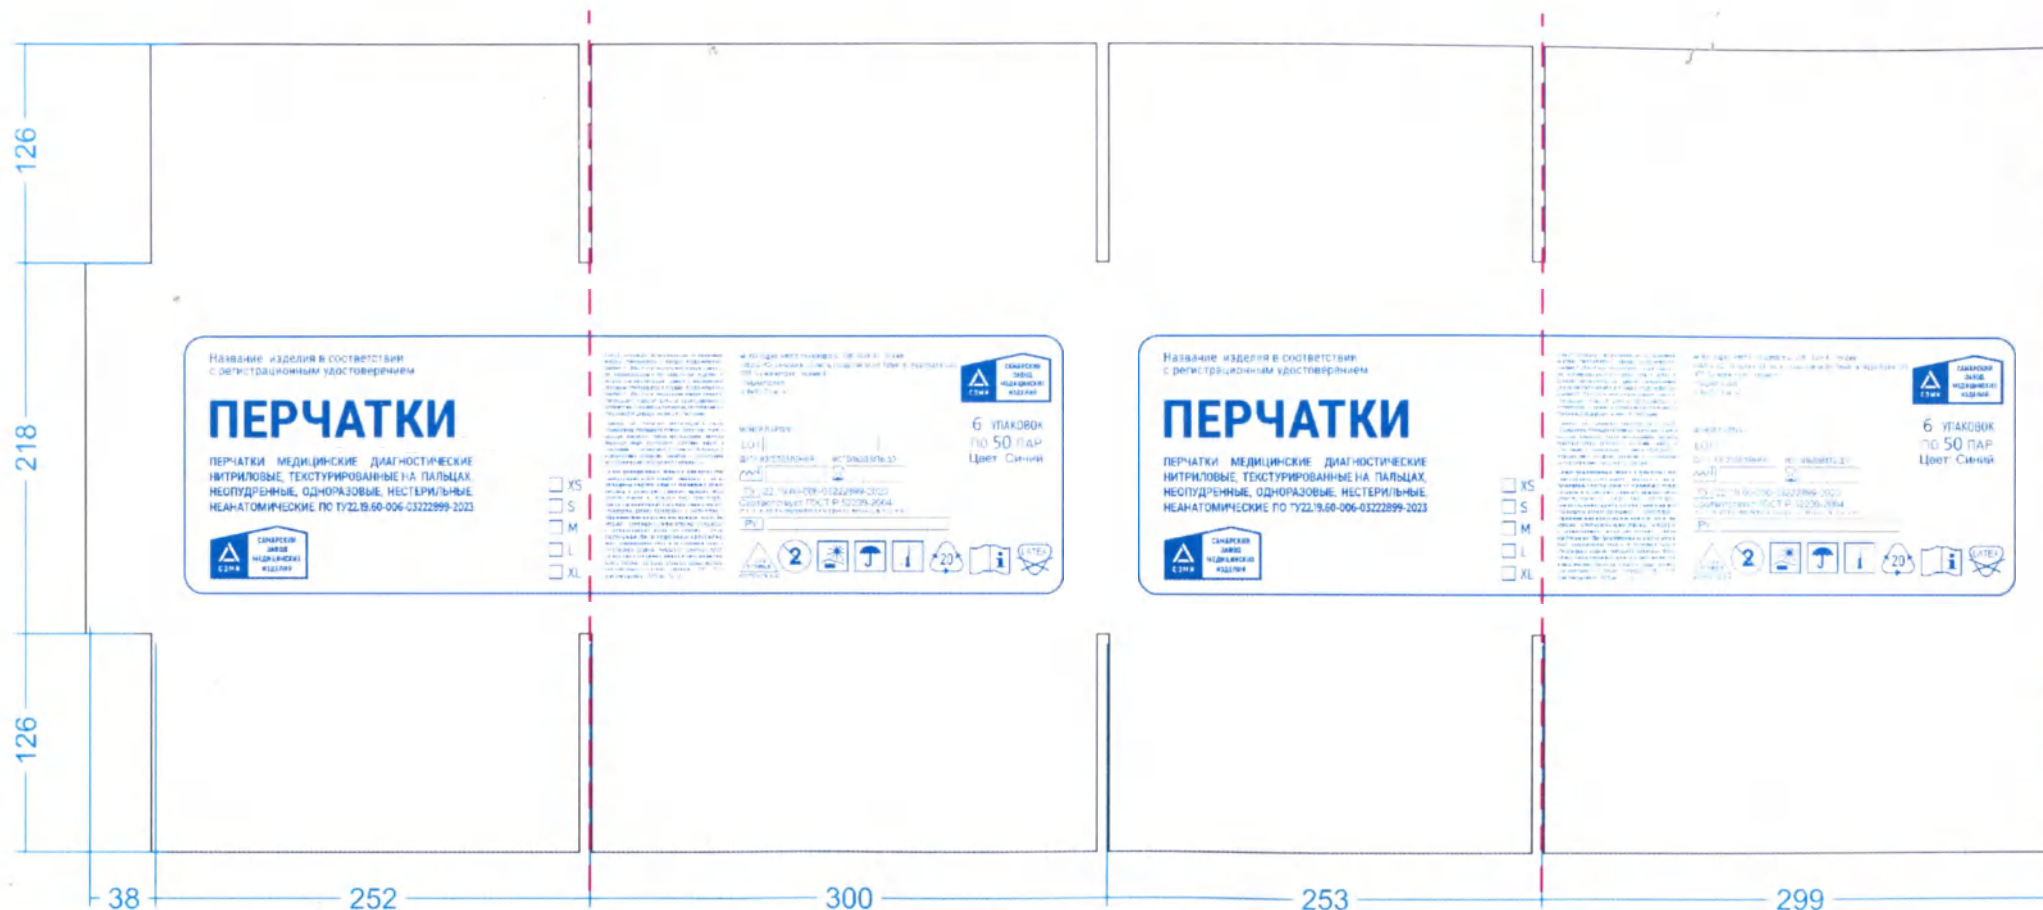

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов
Директор
ООО «СЗМИ»

Земсков А. В.

