

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регуляторным вопросам

ООО «Эбботт Лабораториз»

А.А. Киселева

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Управляемый интродьюсер Agilis, моделей NxT и EPI
(производство St. Jude Medical («Сент Джуд Медикал»), США)

Управляемый интродюсер Agilis, моделей NxT и EPI

Размер: см. на упаковке

**Производитель: Сент Джуд Медикал (St. Jude Medical),
14901 De Veau Place, Minnetonka, MN 55345-2126**

Страна происхождения: см. на упаковке

Код партии (Lot): см. на упаковке

Срок годности (Exp): см. на упаковке

Условия хранения: см. на упаковке

Информация о стерильности: см. на упаковке

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровка графических символов: см. инструкцию по применению

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Тел./факс: +7(495)-258-42-80/81

РУ № ФСЗ 2010/06218 от ХХ.ХХ.ХХХХ



Фото 1. Комплект управляемого интродьюсера Agilis EPI G408333

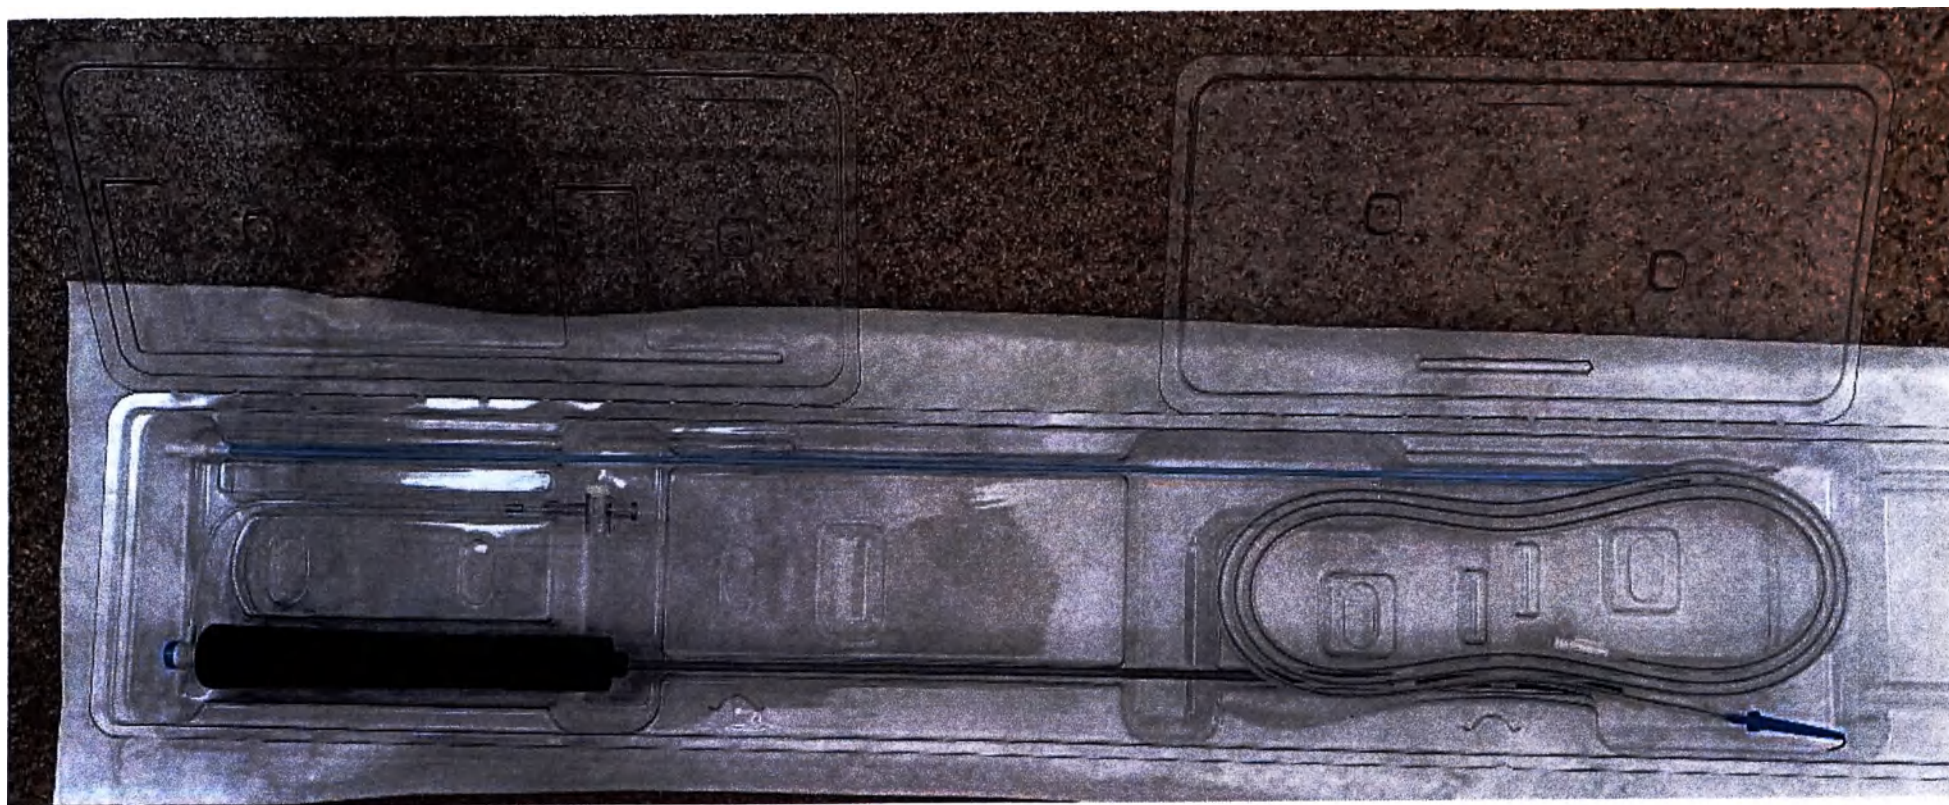


Фото 2. Комплект управляемых интродьюсеров Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332)

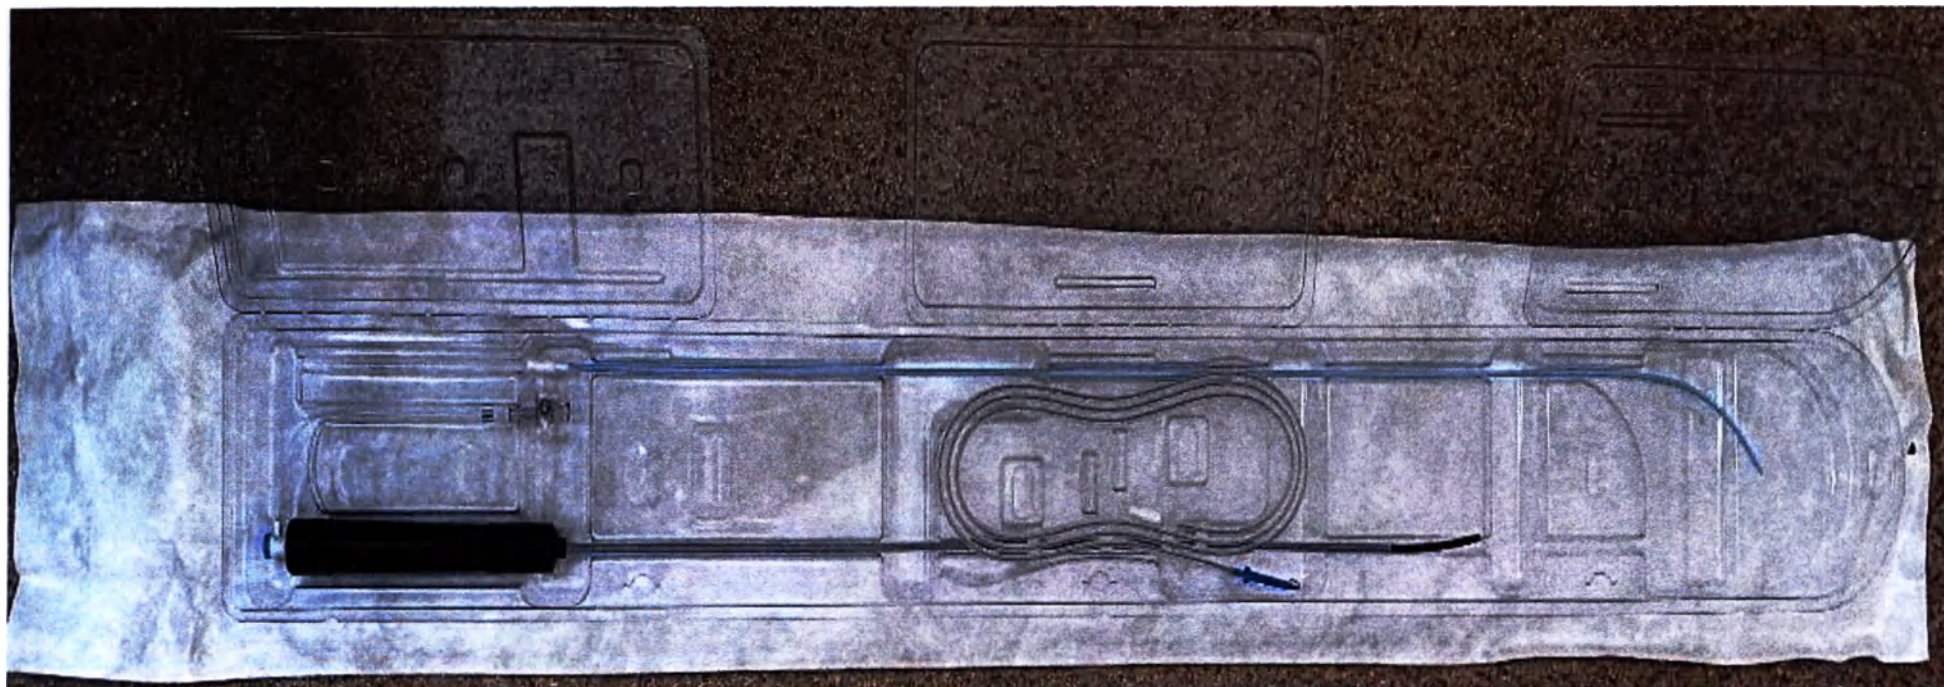


Фото 3. Управляемый интродюсер Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332)



Фото 4. Управляемый интродюсер Agilis EPI G408333

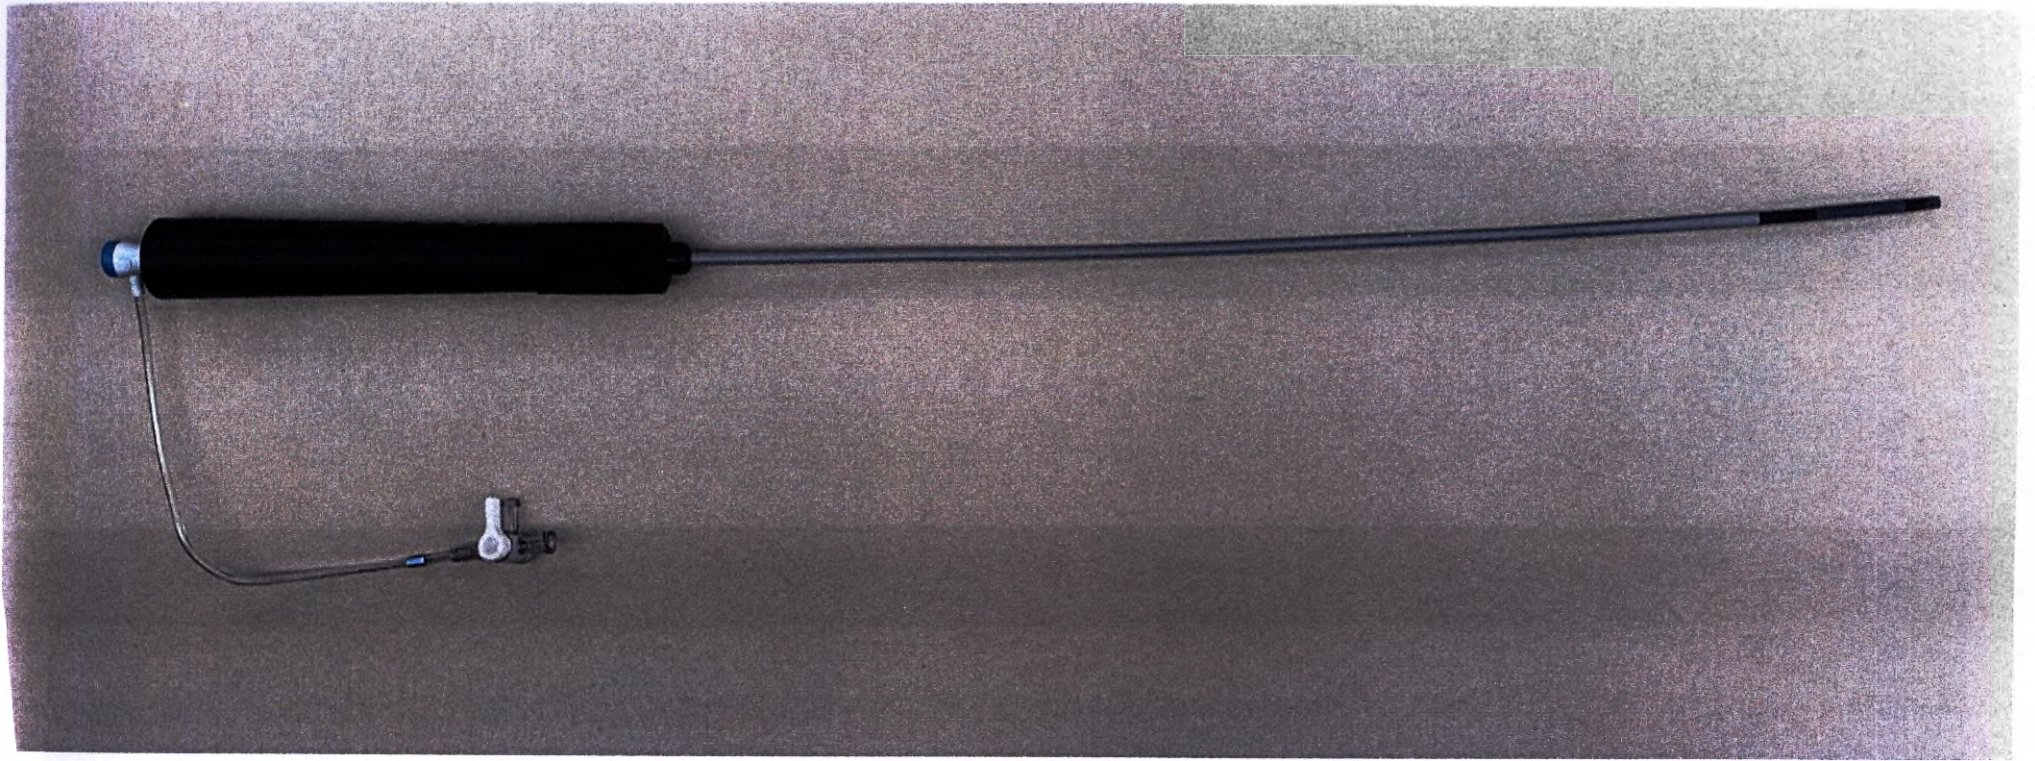


Фото 5. Расширитель



Фото 6. Проволочный проводник

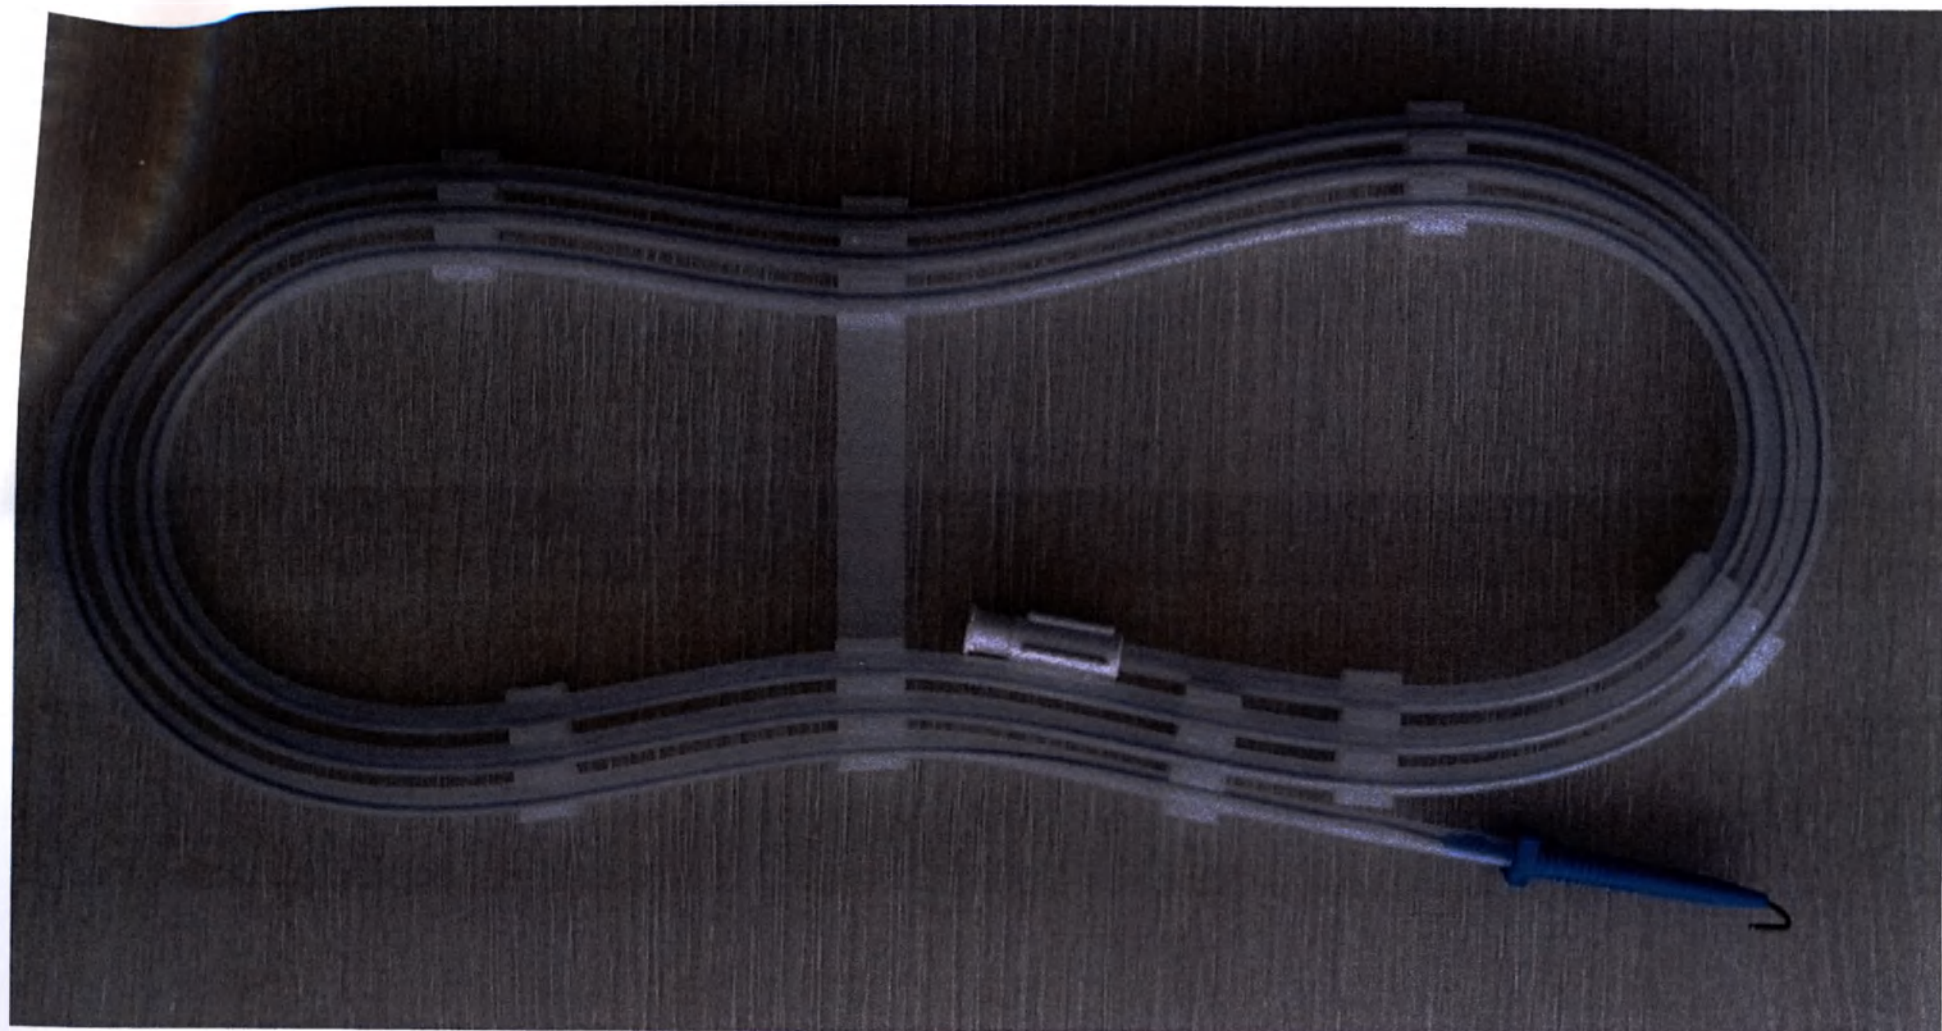


Фото 7. Индивидуальная упаковка комплекта управляемого интродьюсера Agilis EPI G408333

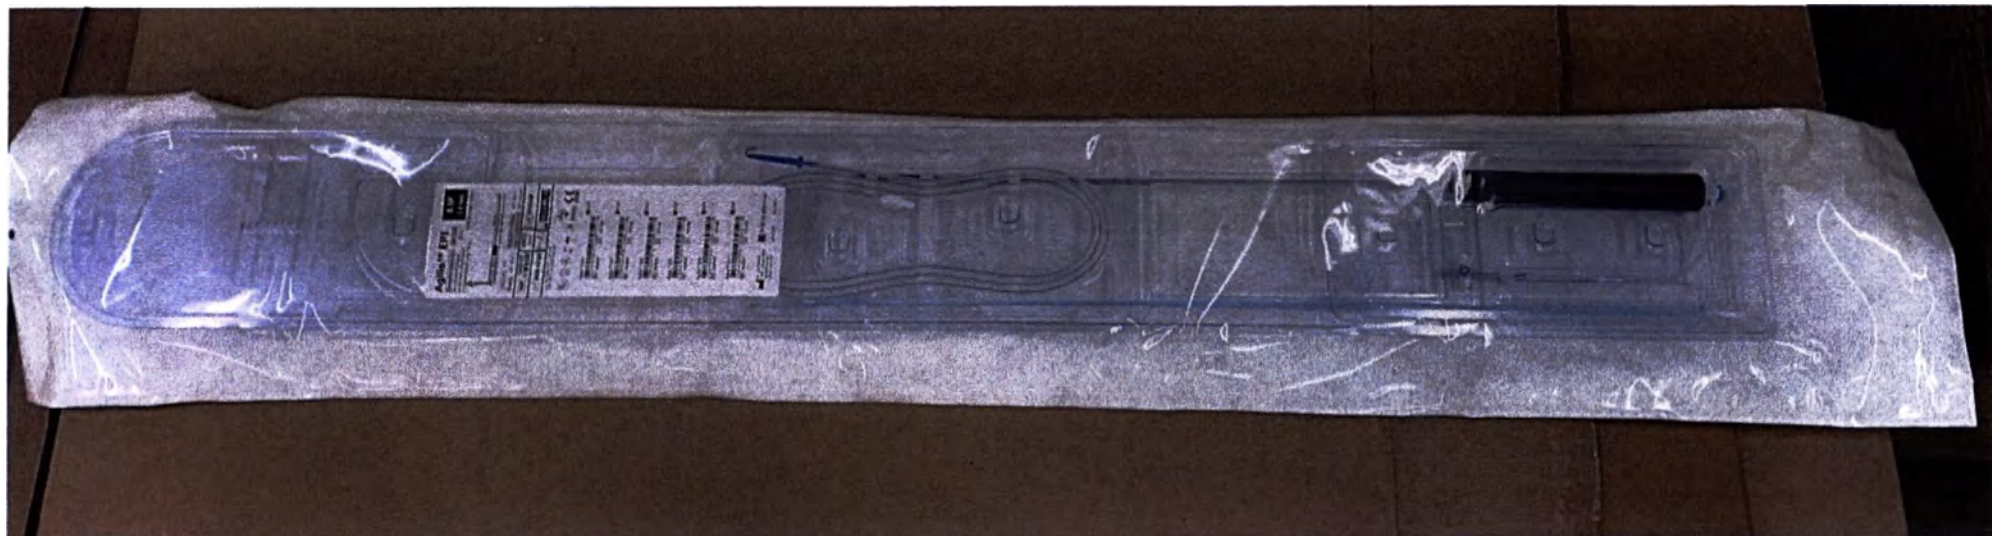


Фото 8. Маркировка индивидуальной упаковки комплекта управляемого интродьюсера Agilis EPI G408333

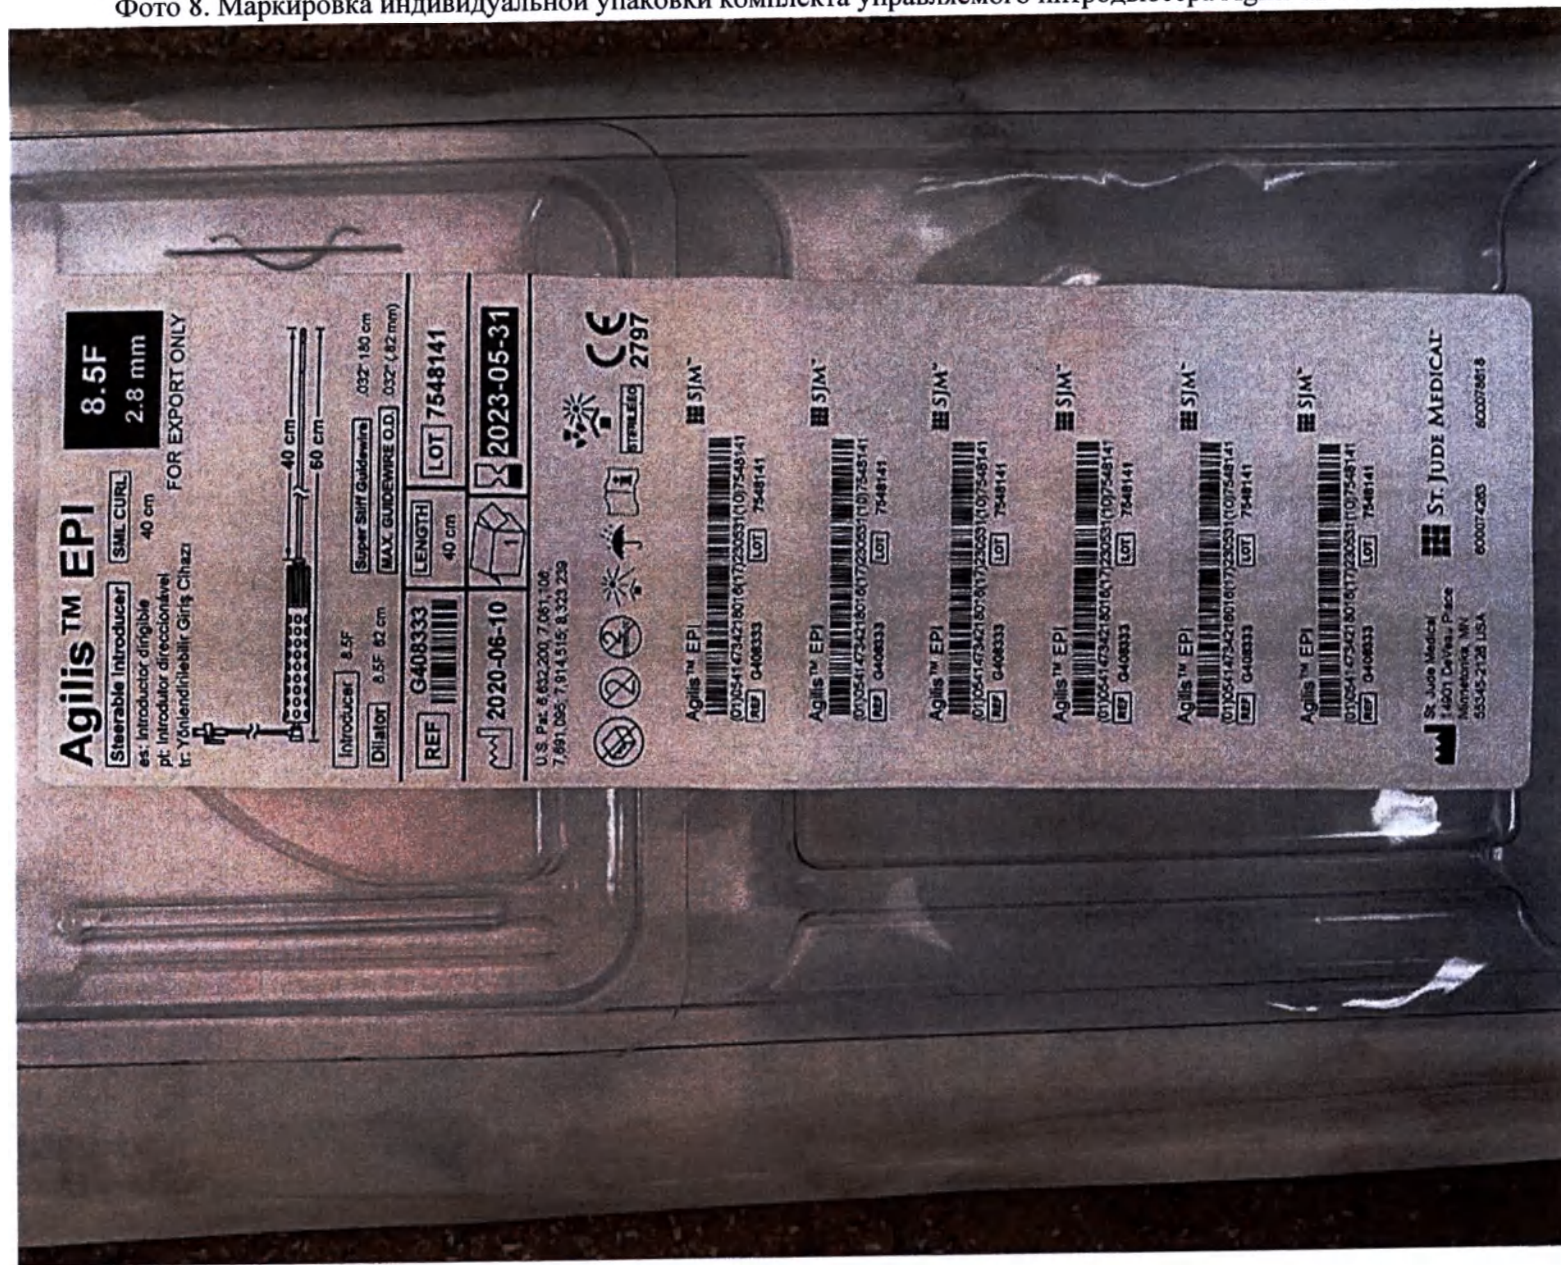


Фото 9. Потребительская упаковка комплекта управляемого интродьюсера Agilis EPI G408333



Фото 10. Маркировка потребительской упаковки комплекта управляемого интродьюсера Agilis EPI G408333

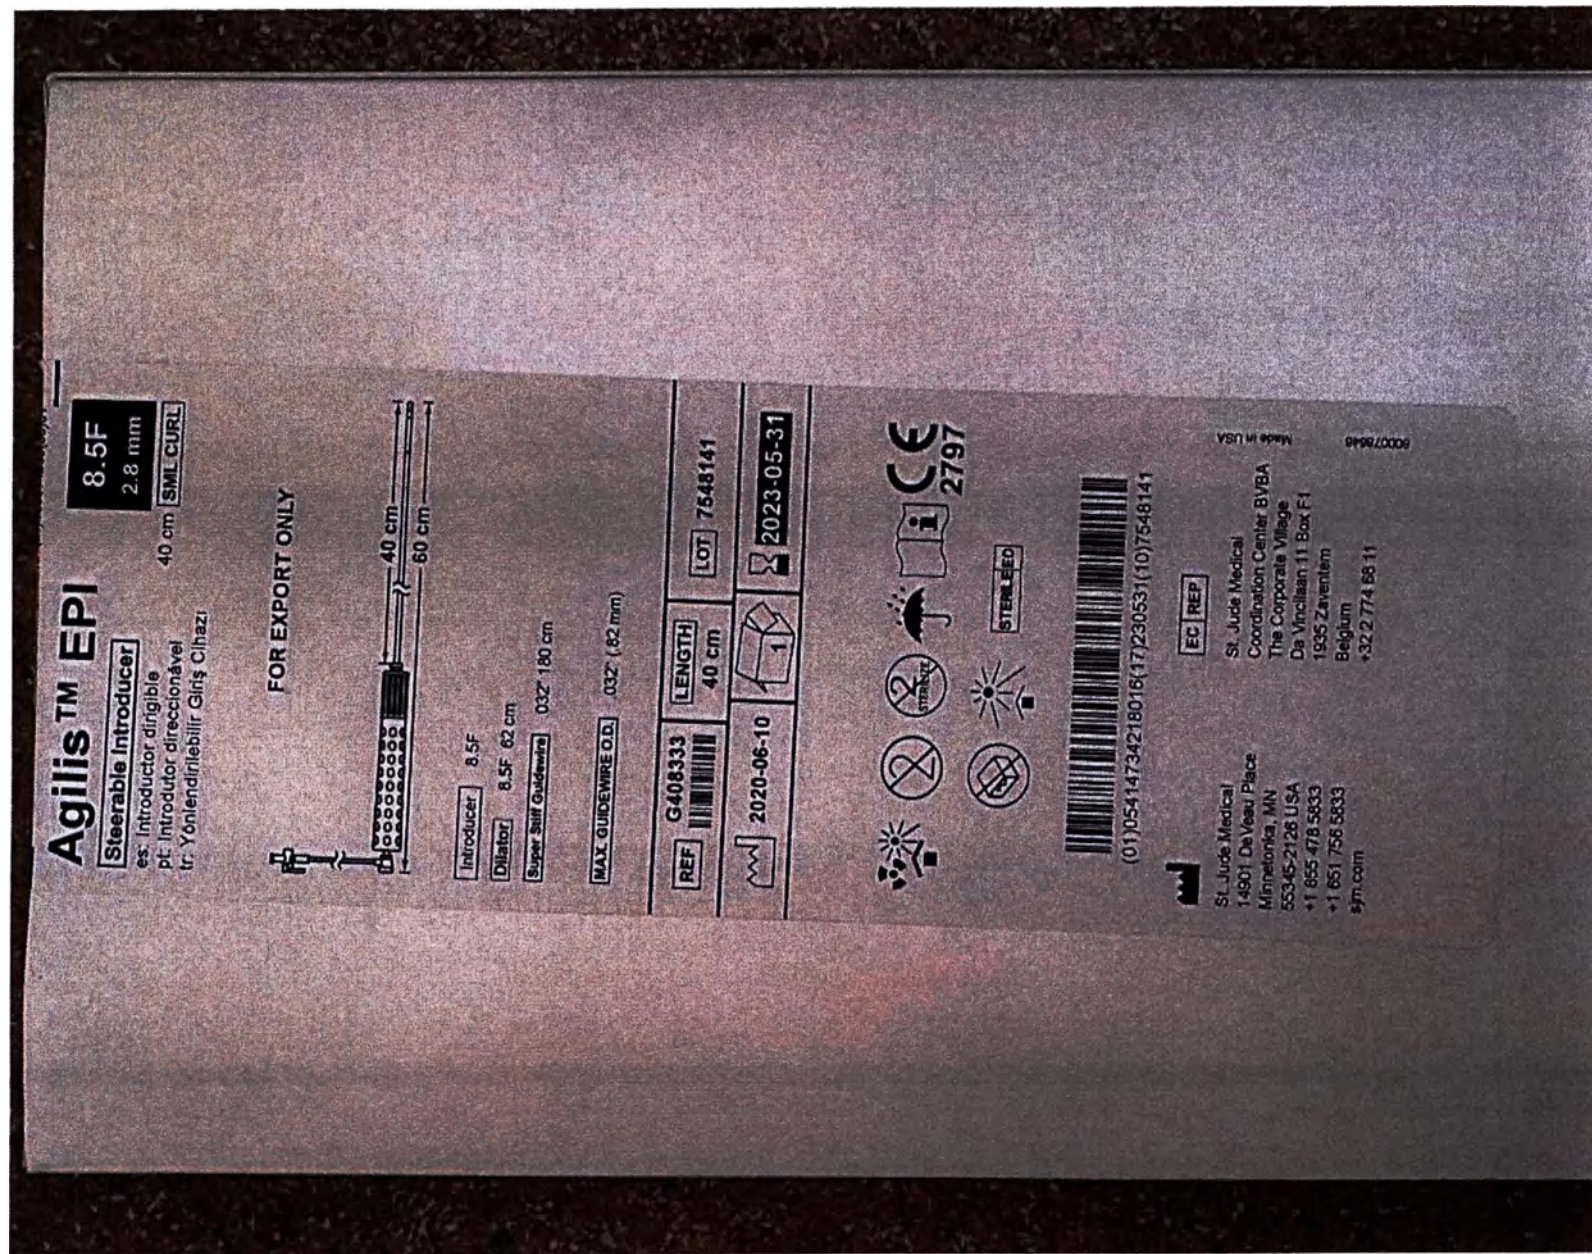


Фото 11. Индивидуальная упаковка комплекта управляемых интродьюсеров Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332)

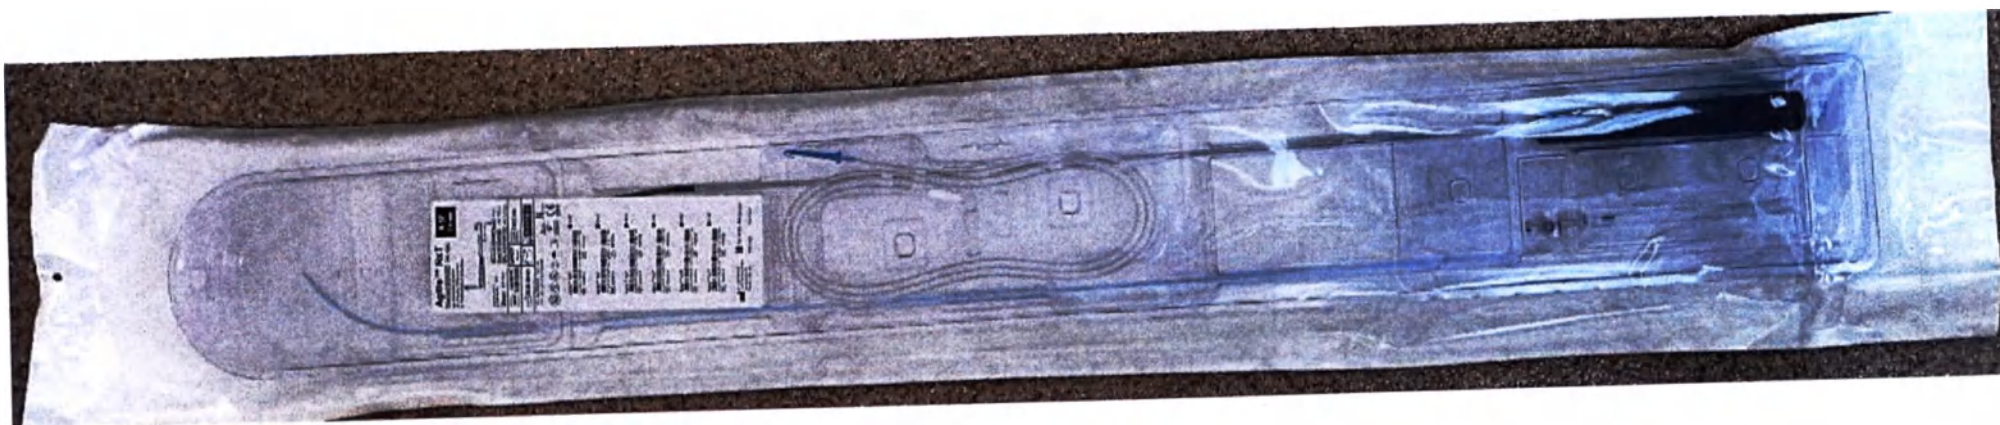


Фото 12. Маркировка индивидуальной упаковки комплекта управляемых интродьюсеров Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332)


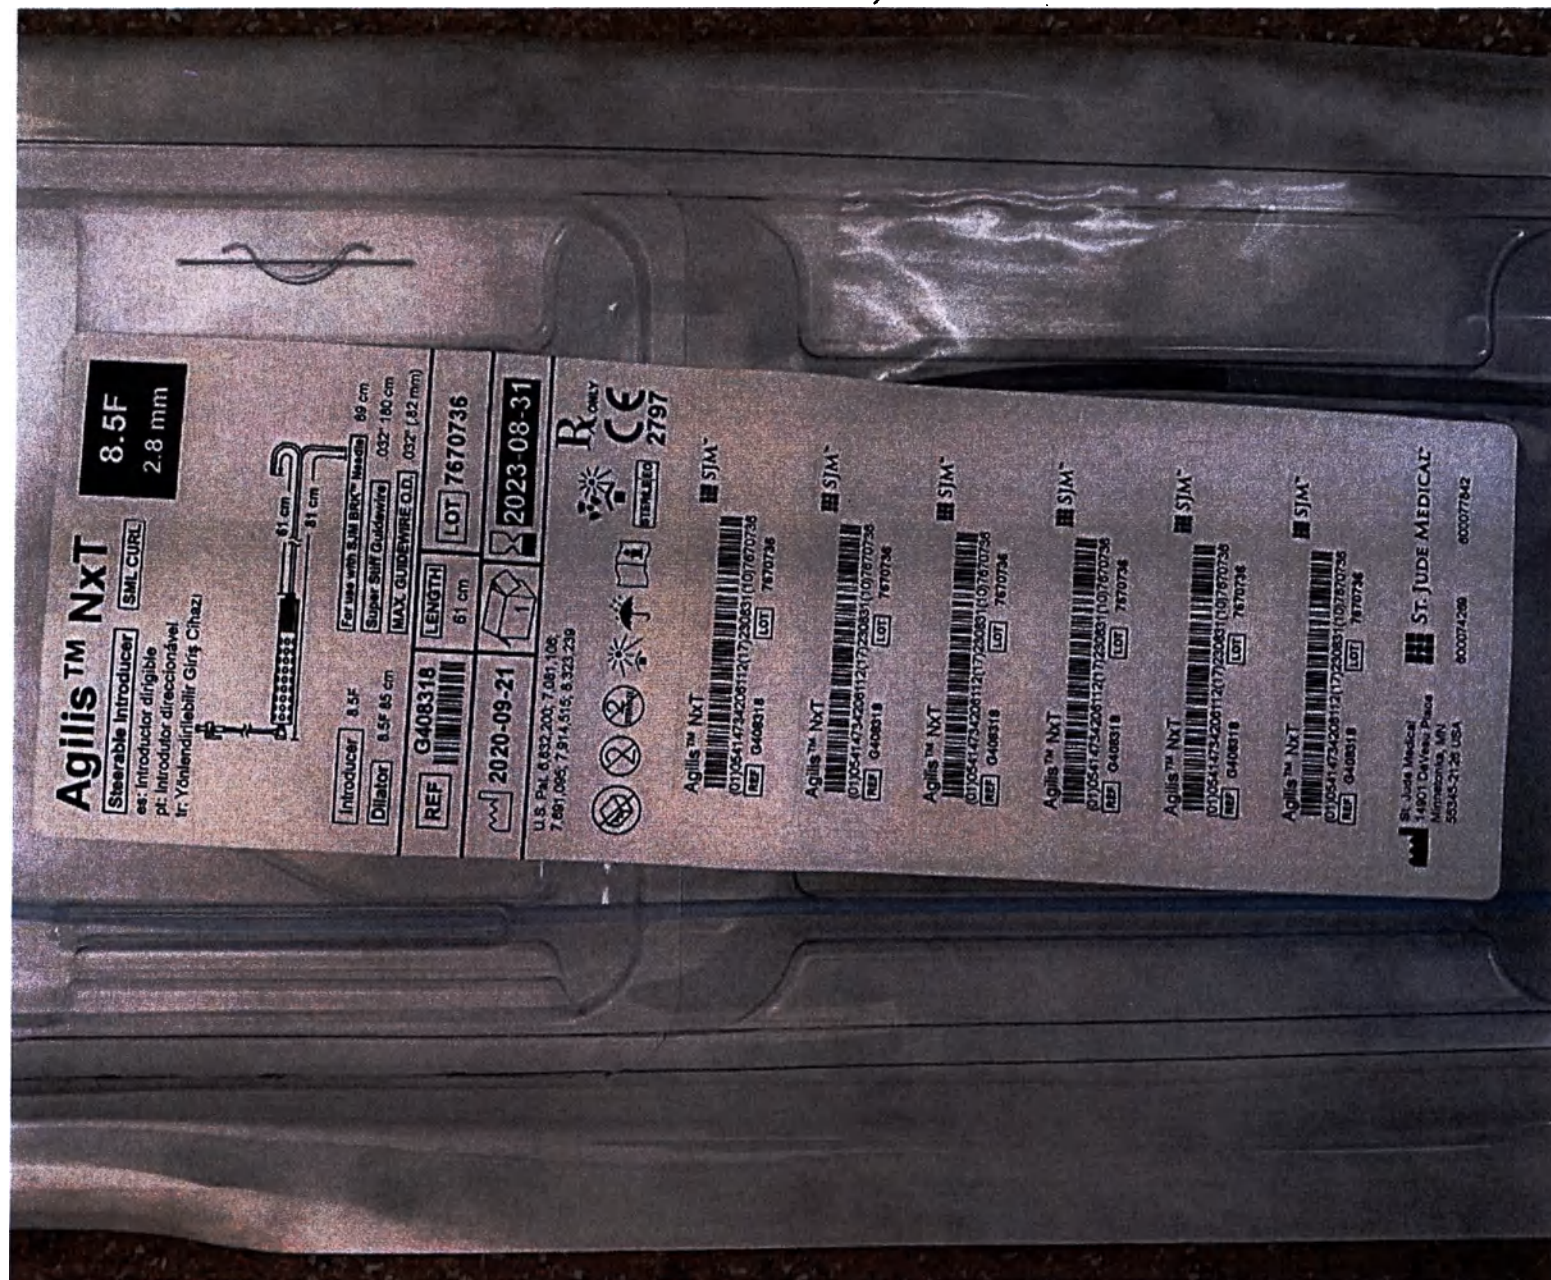


Фото 13. Вторичная упаковка комплекта управляемых интродьюсеров Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332)



Фото 14. Маркировка вторичной упаковки комплекта управляемых интродьюсеров Agilis NxT (NxT408309, NxT408310, NxTG408324, NxTG408318, NxTG408332).

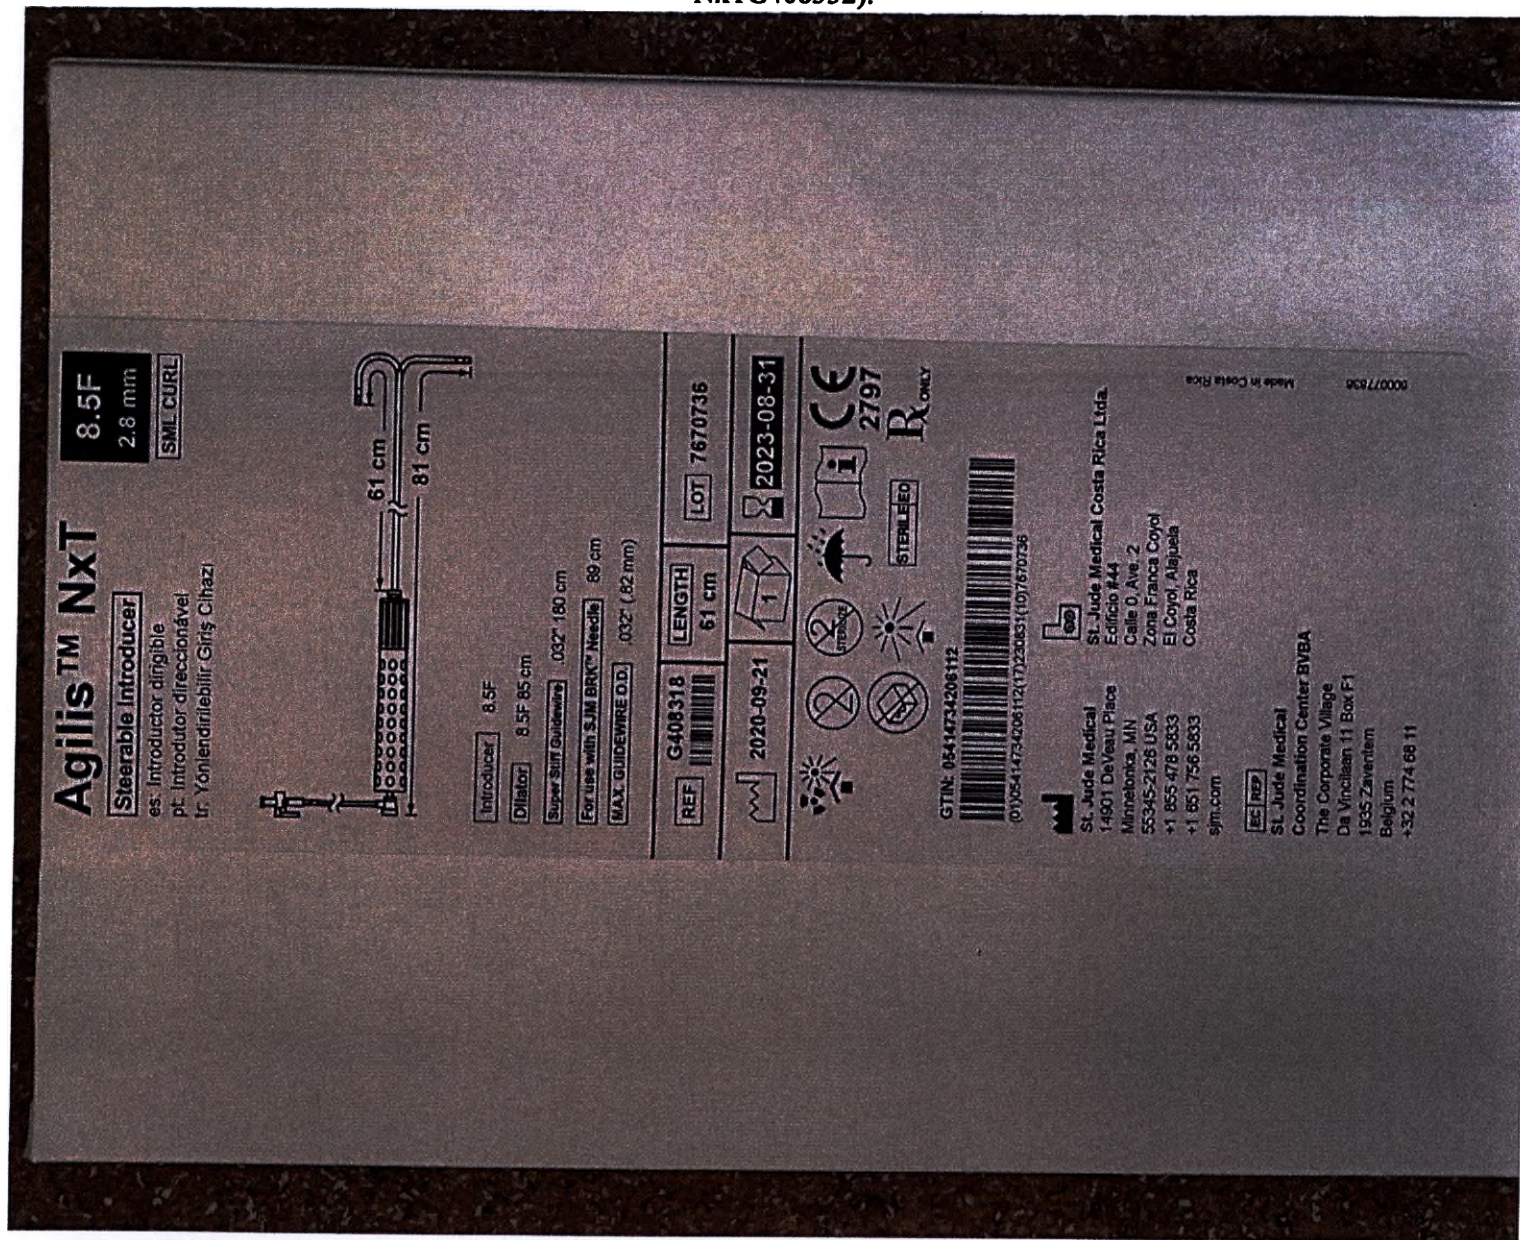

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов

Общество с ограниченной ответственностью
«Эбботт Лэбораториз»

Менеджер по регуляторным вопросам
Киселева А.А.

