

Внешний вид

Реагент для определения протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН-АВТО ДДС) по ТУ 21.20.23.110-209-48813770-2023



Вариант 1, Комплектация 1



Внешний вид

Реагент для определения протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН-АВТО ДДС) по ТУ 21.20.23.110-209-48813770-2023



1, Комплектация 2

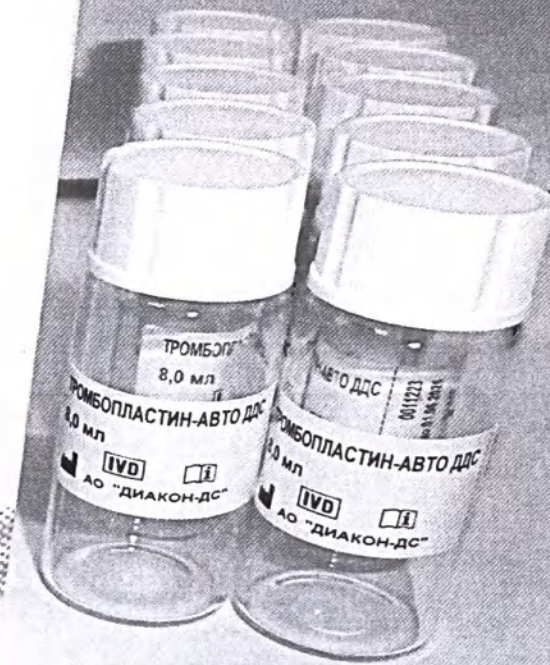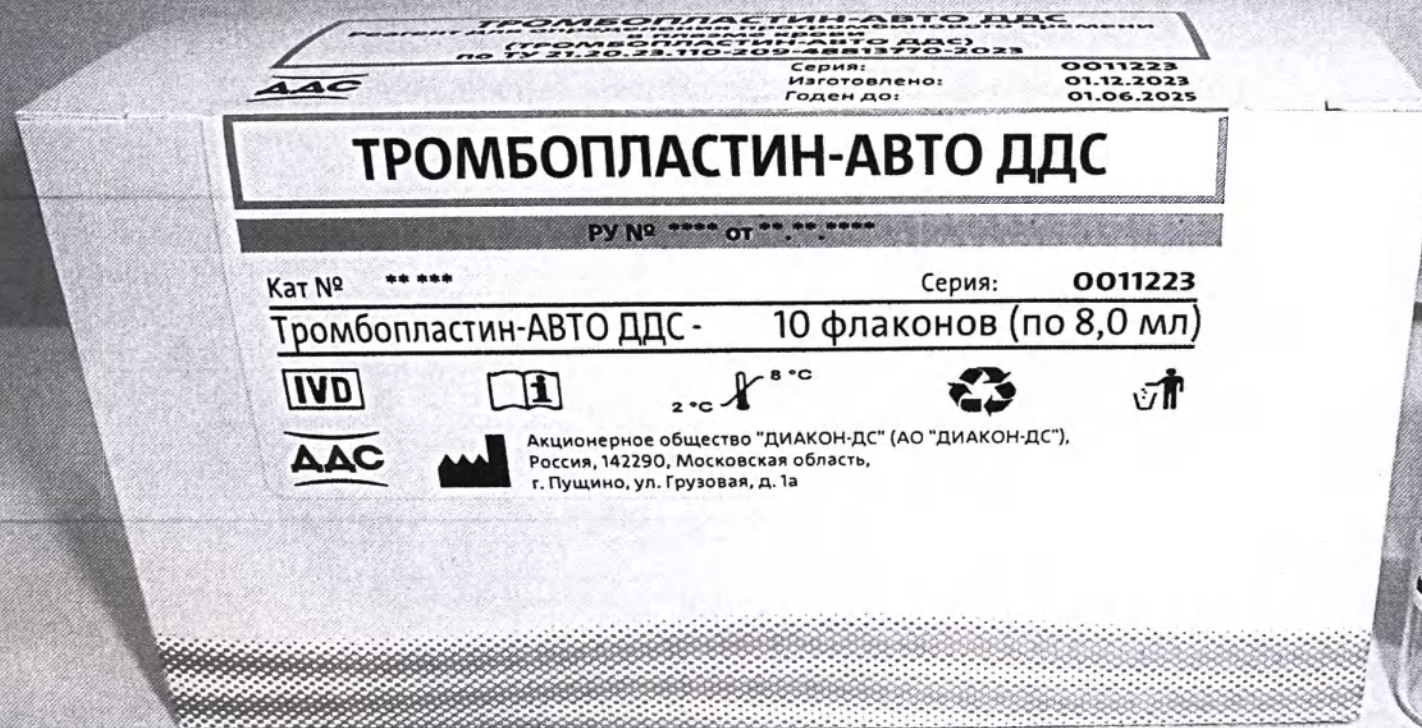

Внешний вид

Реагент для определения протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН-АВТО ДДС) по ТУ 21.20.23.110-209-48813770-2023



2, Комплектация 1

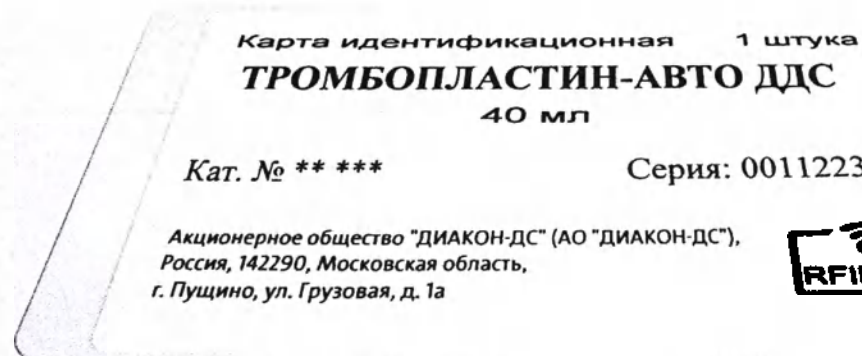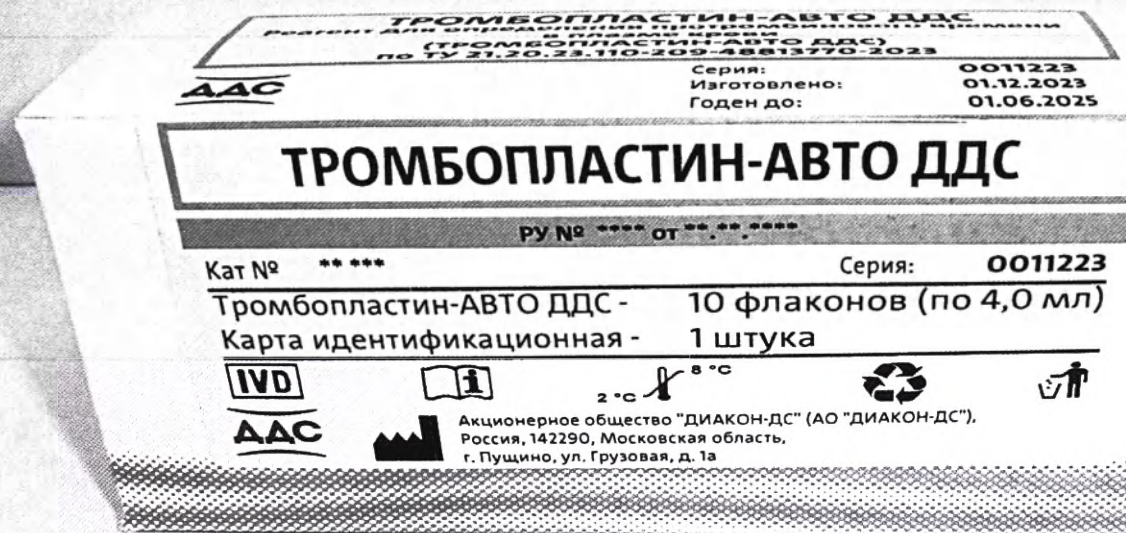


Внешний вид

Реагент для определения протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН-АВТО ДДС) по ТУ 21.20.23.110-209-48813770-2023

2, Комплектация 2

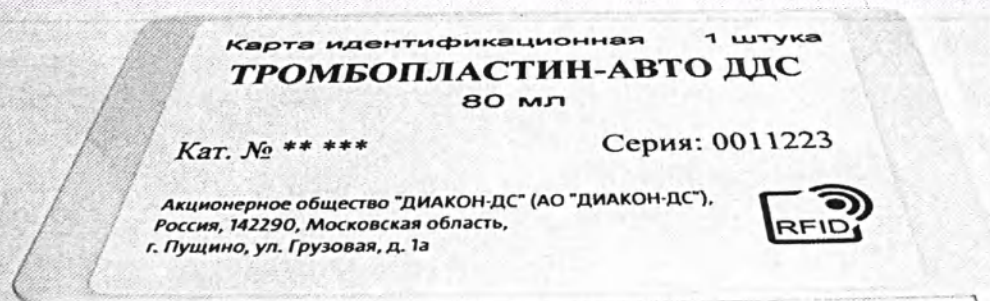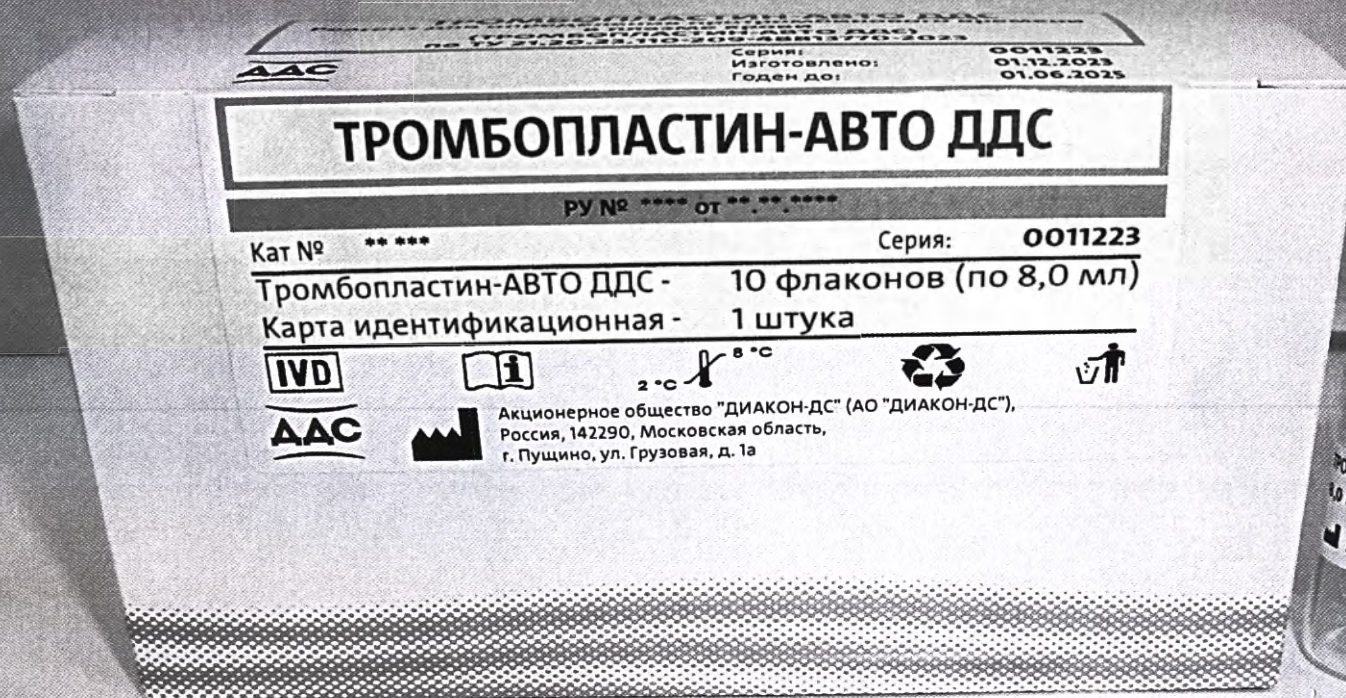

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

 Т.Ю. Корзун

