

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
Заводовский Д. В.



«29» июля 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec
с принадлежностями, в вариантах исполнения (Cromatec Staining Systems)**

1. Основной состав медицинского изделия

Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec I, в составе:


Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec I, арт. 17000000/

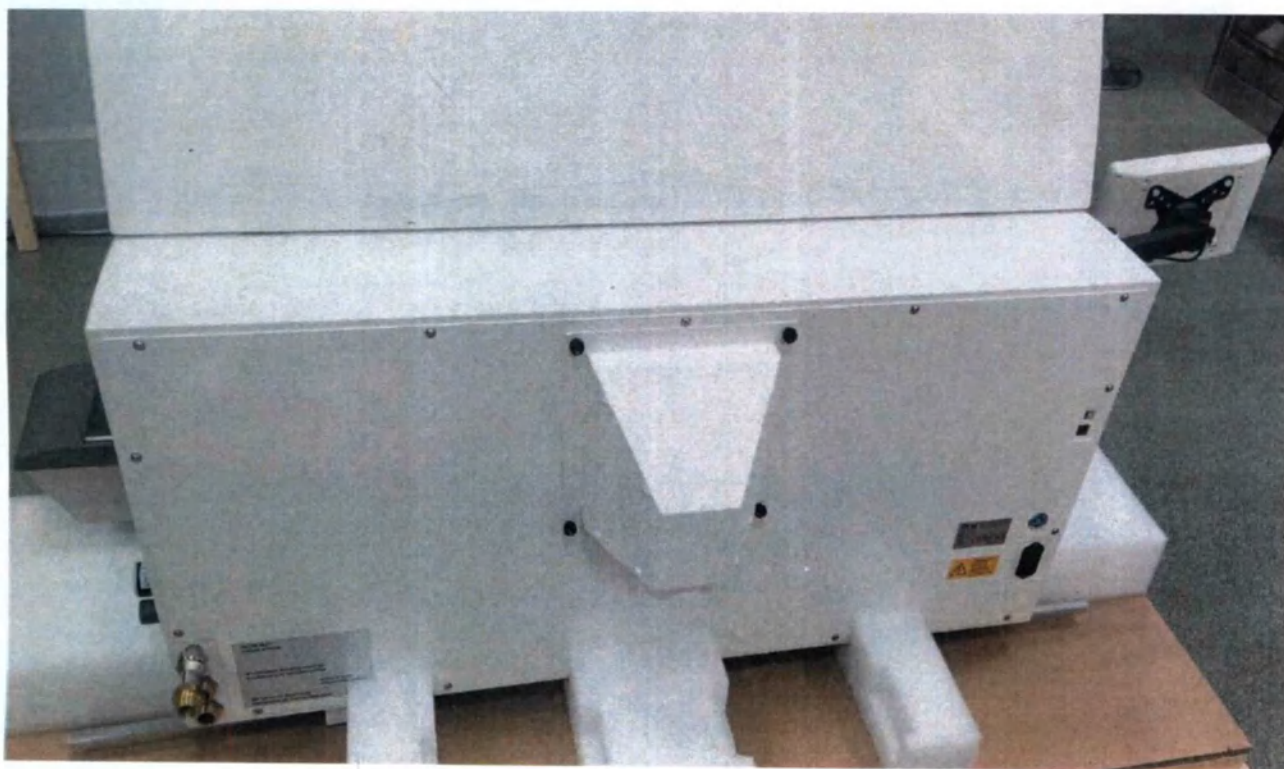

Кабель питания, арт. 70361052




Руководство по эксплуатации

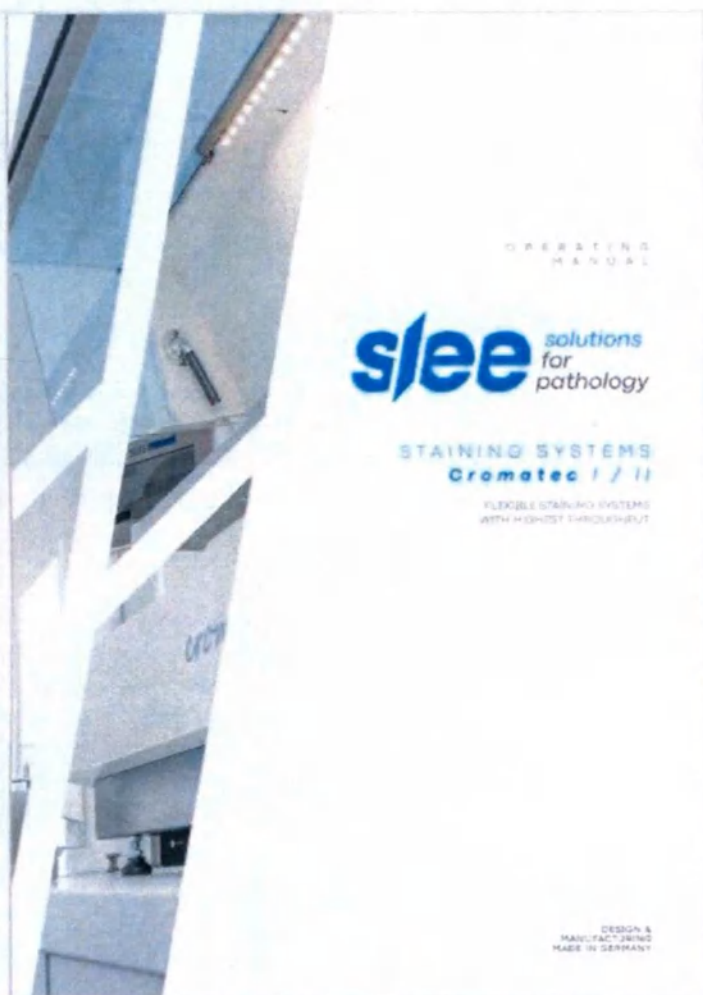


Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec II , в составе:

Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec II, арт. 17000001

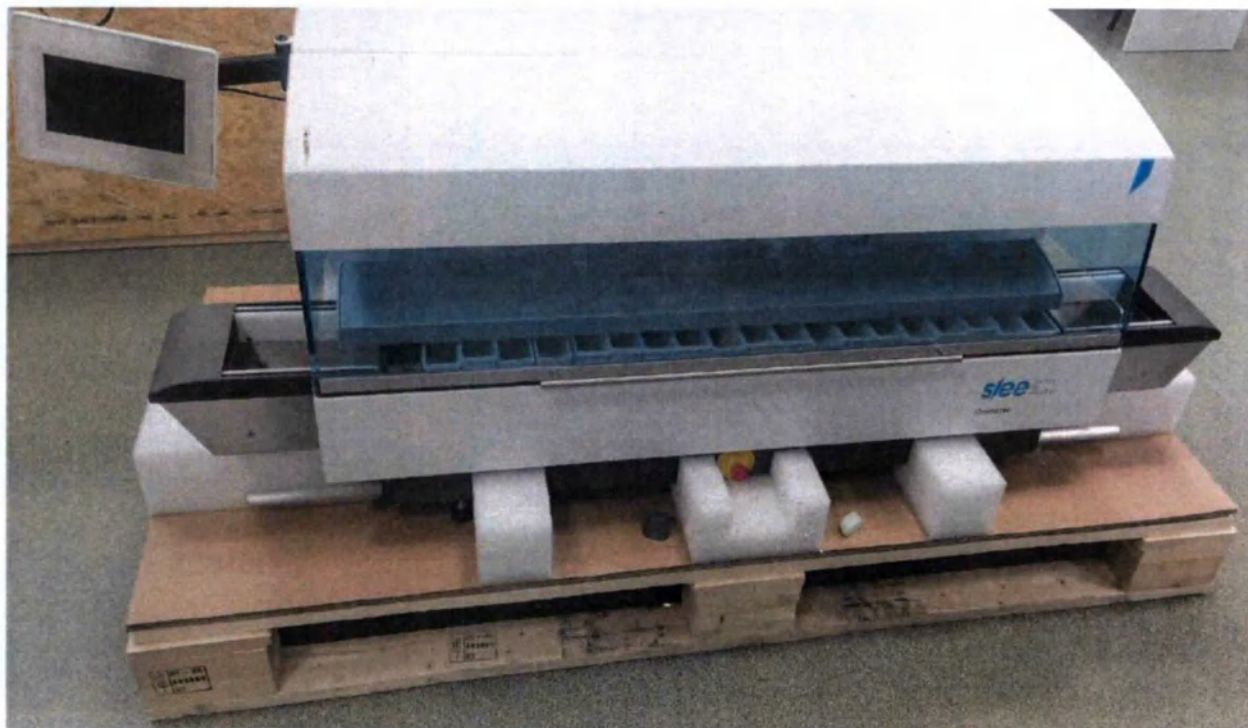

Станция сушки, арт. 41000750

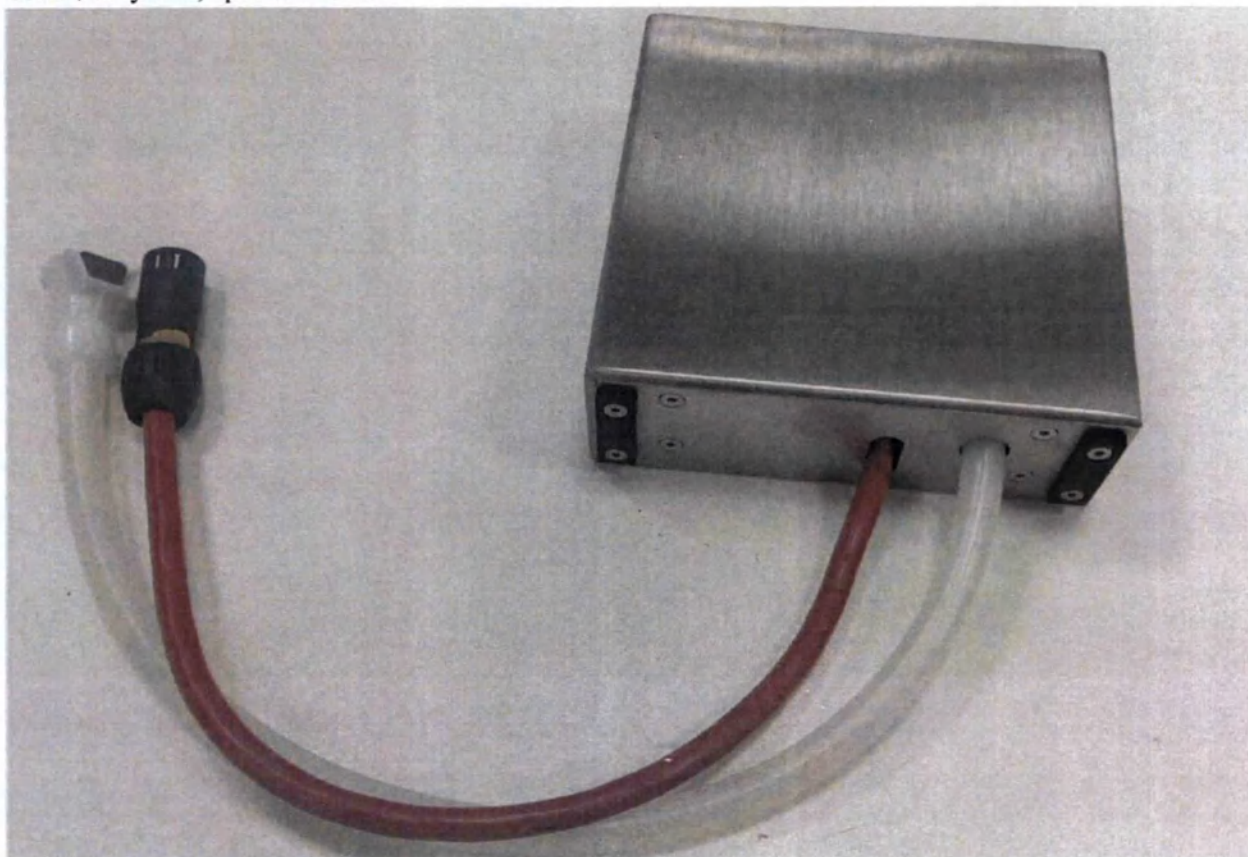

Удлинительный кабель для станции сушки, арт. 41000782






Станция сушки, арт. 41000750


Кабель питания, арт. 70361052



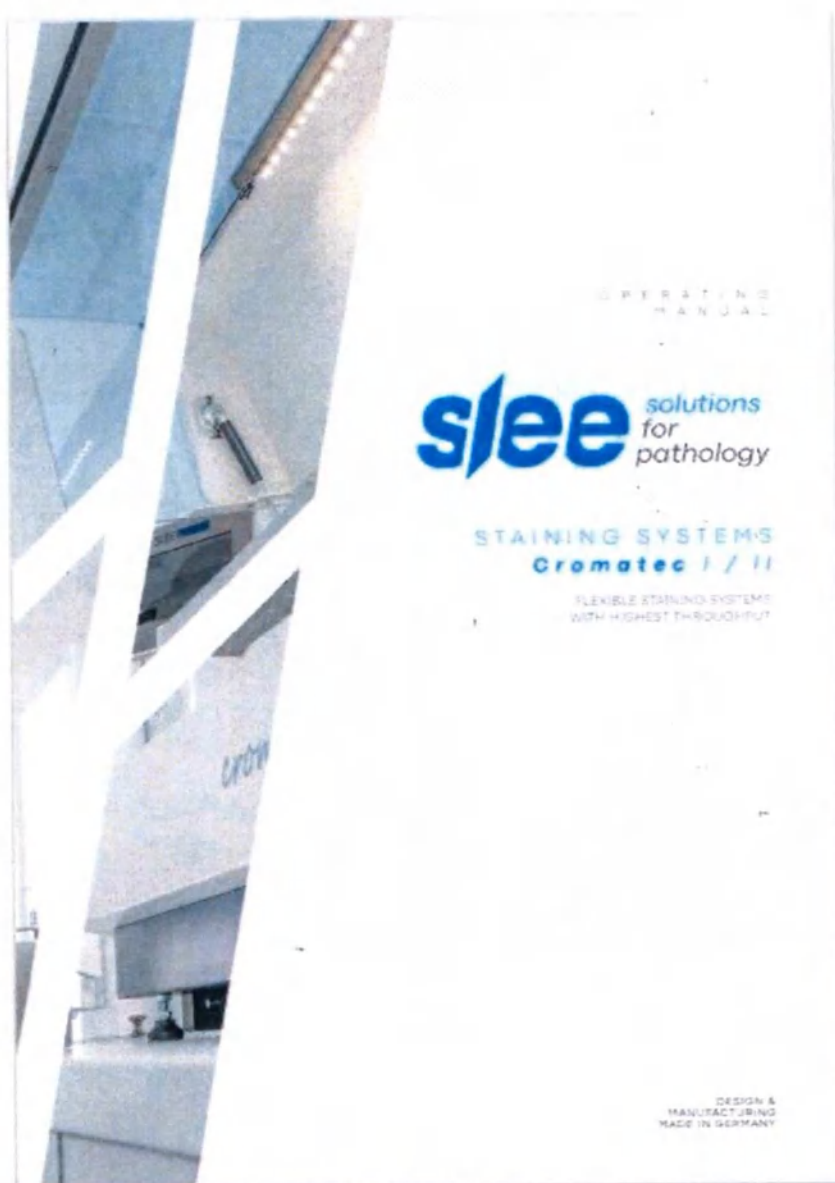


2. Принадлежности


1) Крышка для пластиковых кювет, арт. 41000566

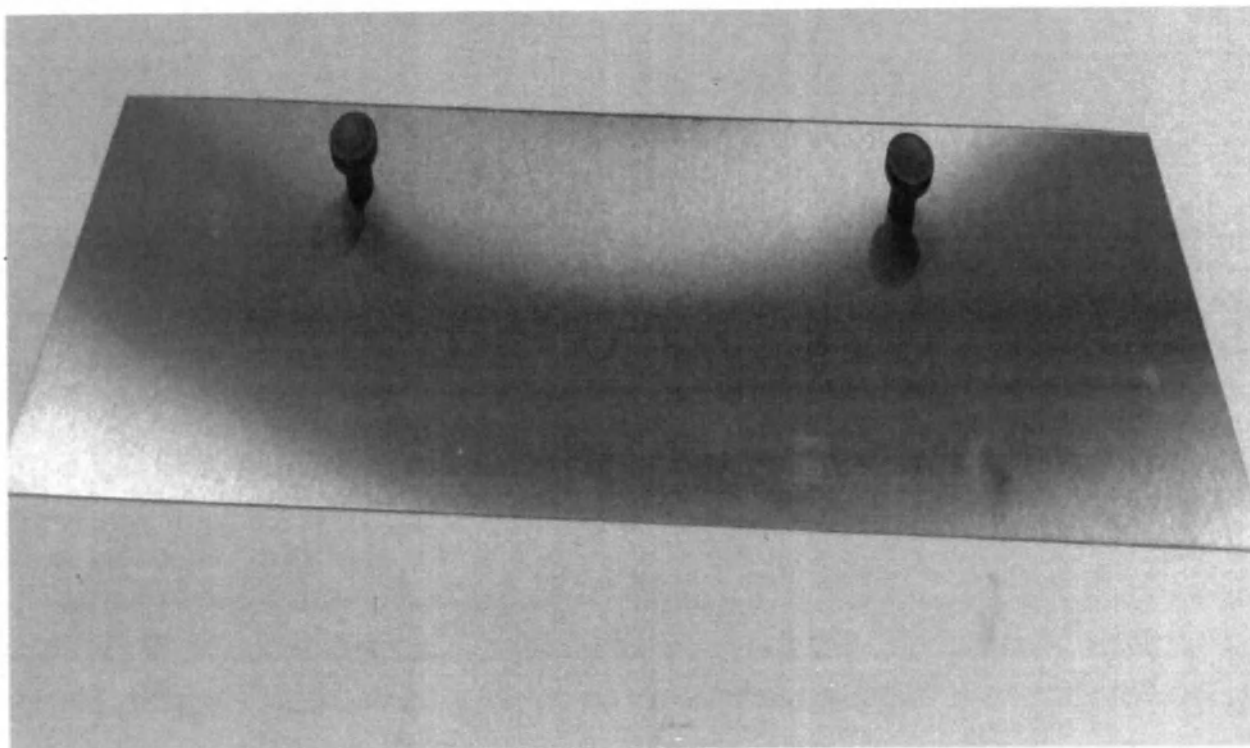


2) Пластиковые кюветы для реагентов, арт. 41000017

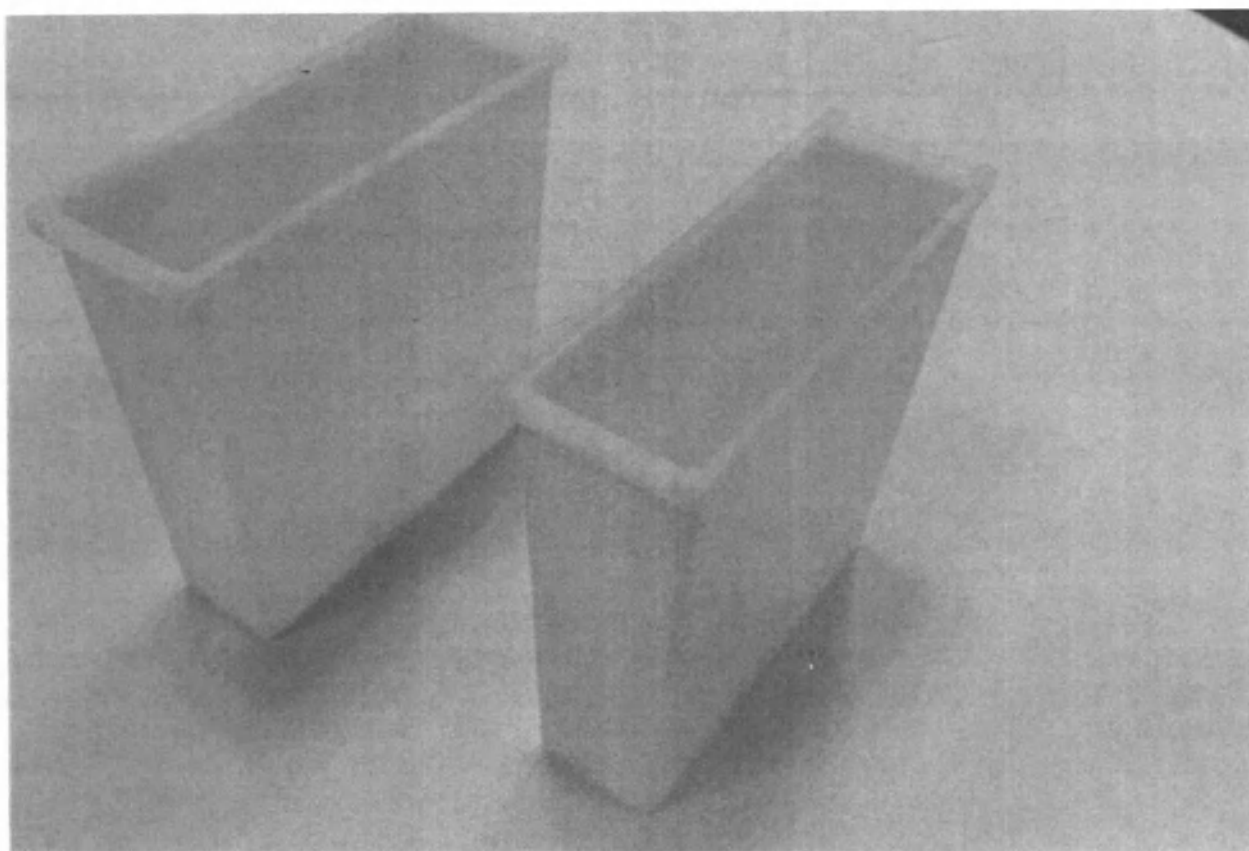



3) Пластиковые кюветы промывочные, арт. 41000410

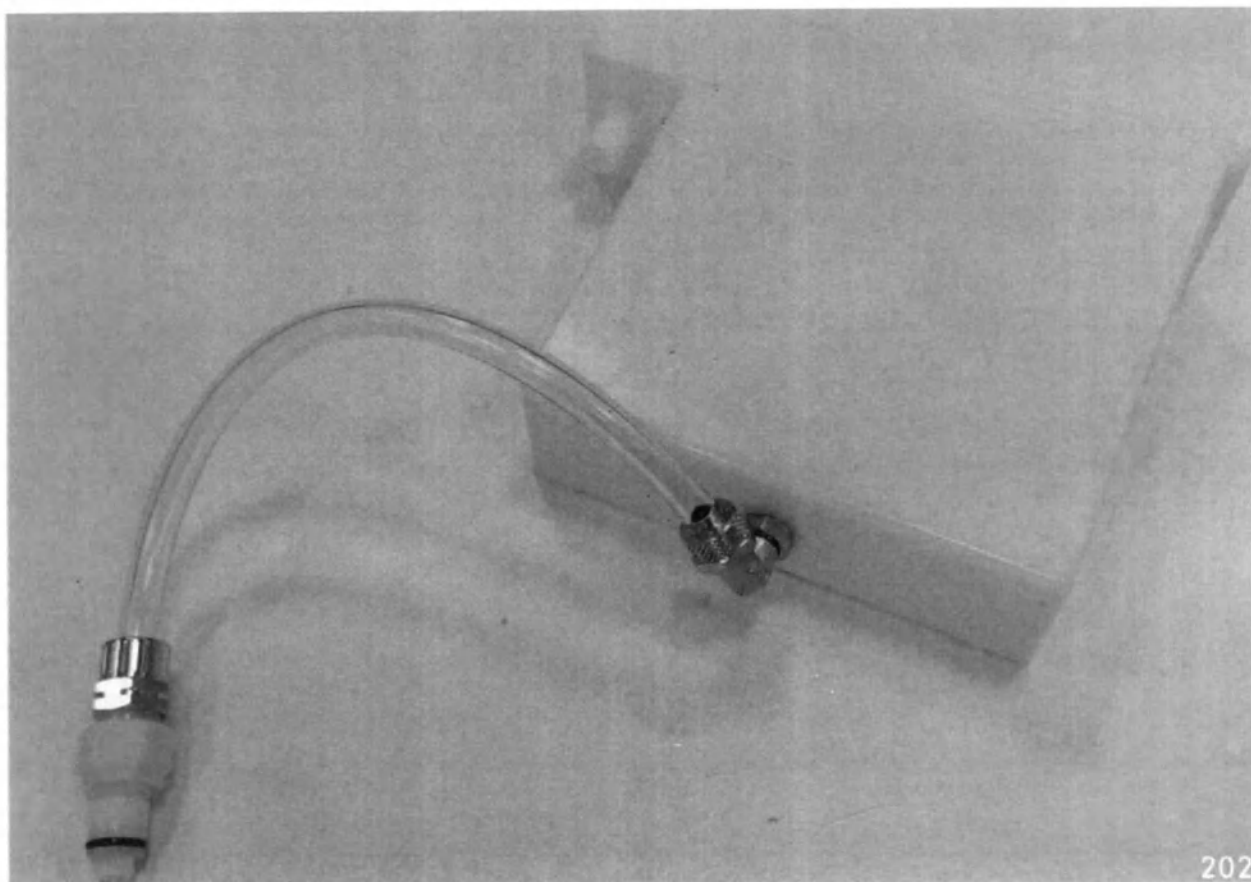


4) Трубка подачи воды для промывочных кювет, арт. 41000584

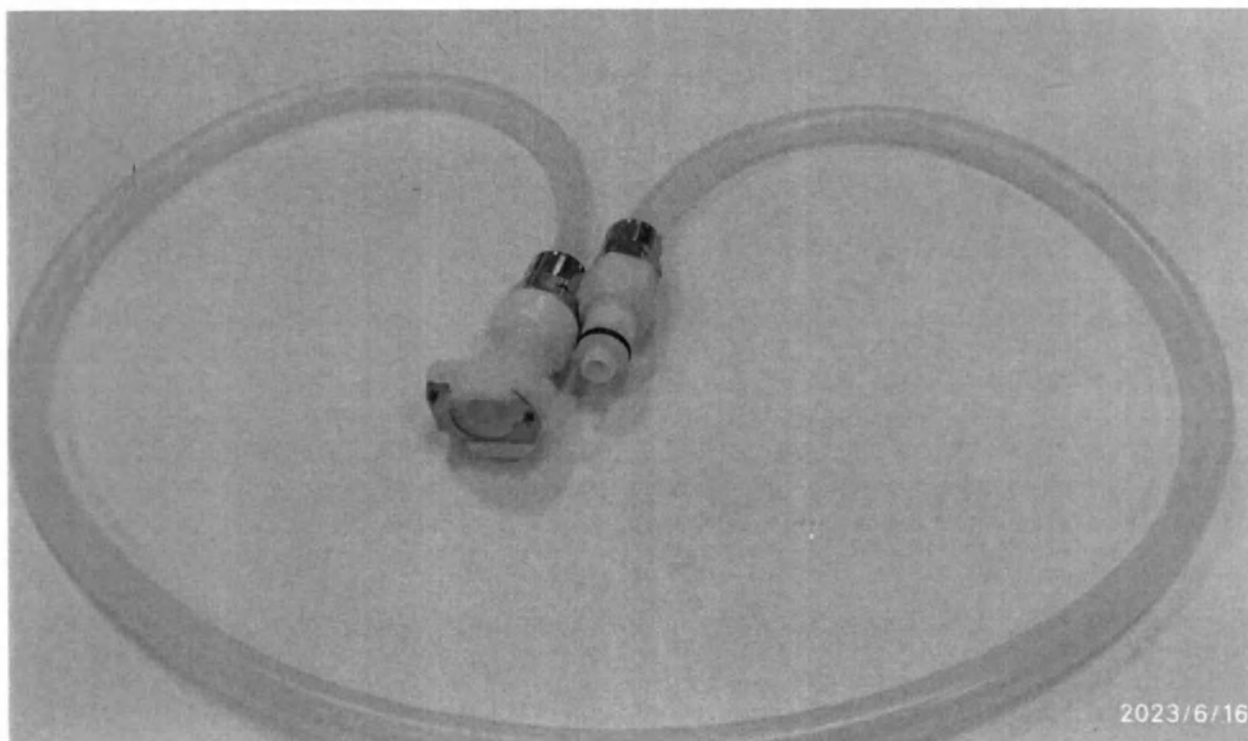


5) Поддон для сбора капель с подъемной пластиной, арт. 41000580

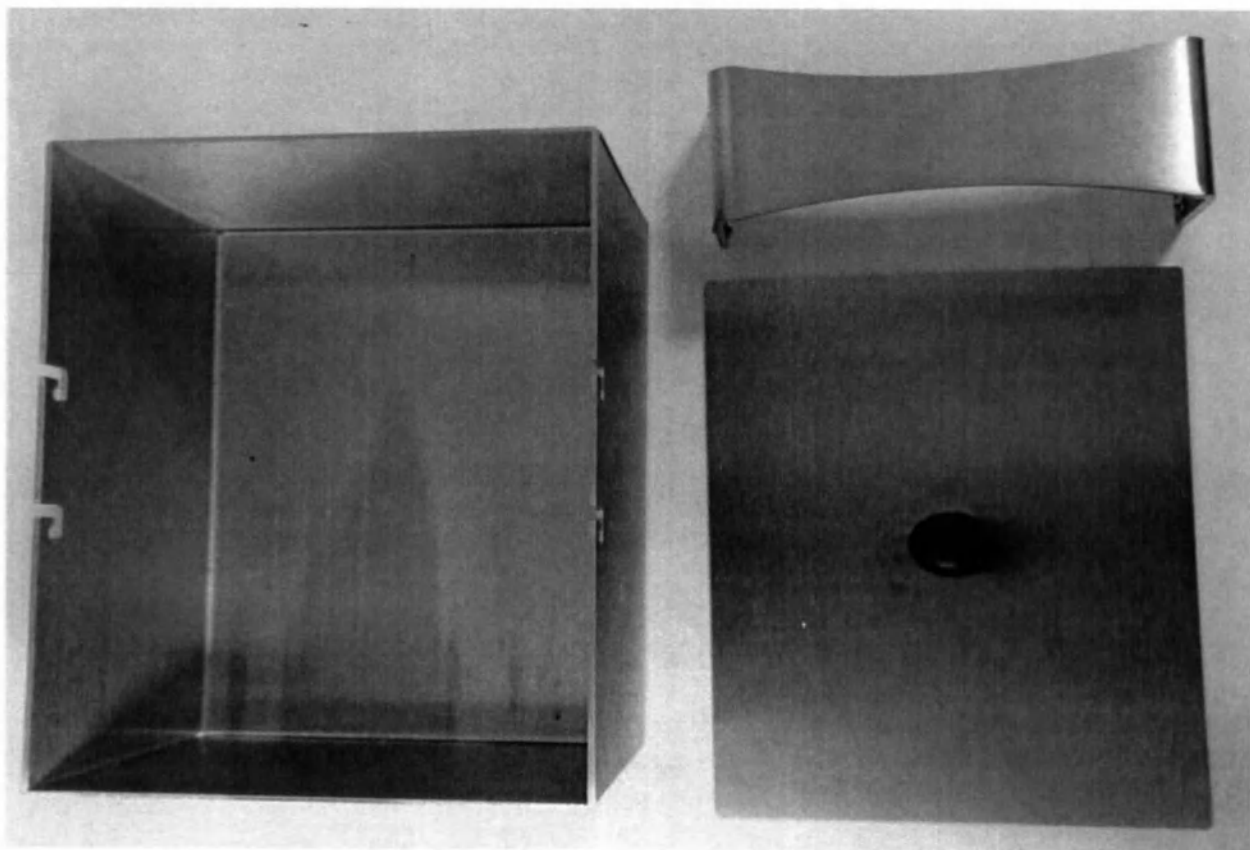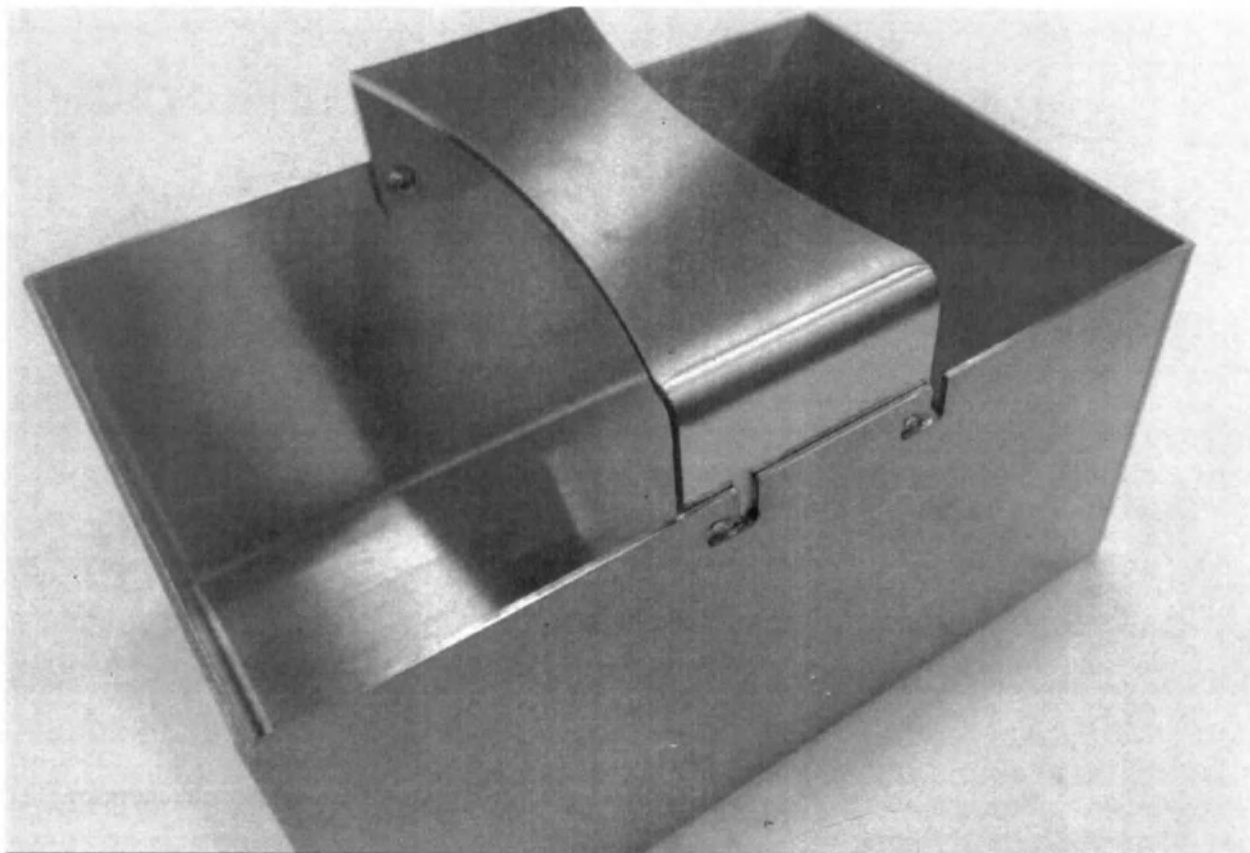


6) Ручка для корзин, арт. 41000270

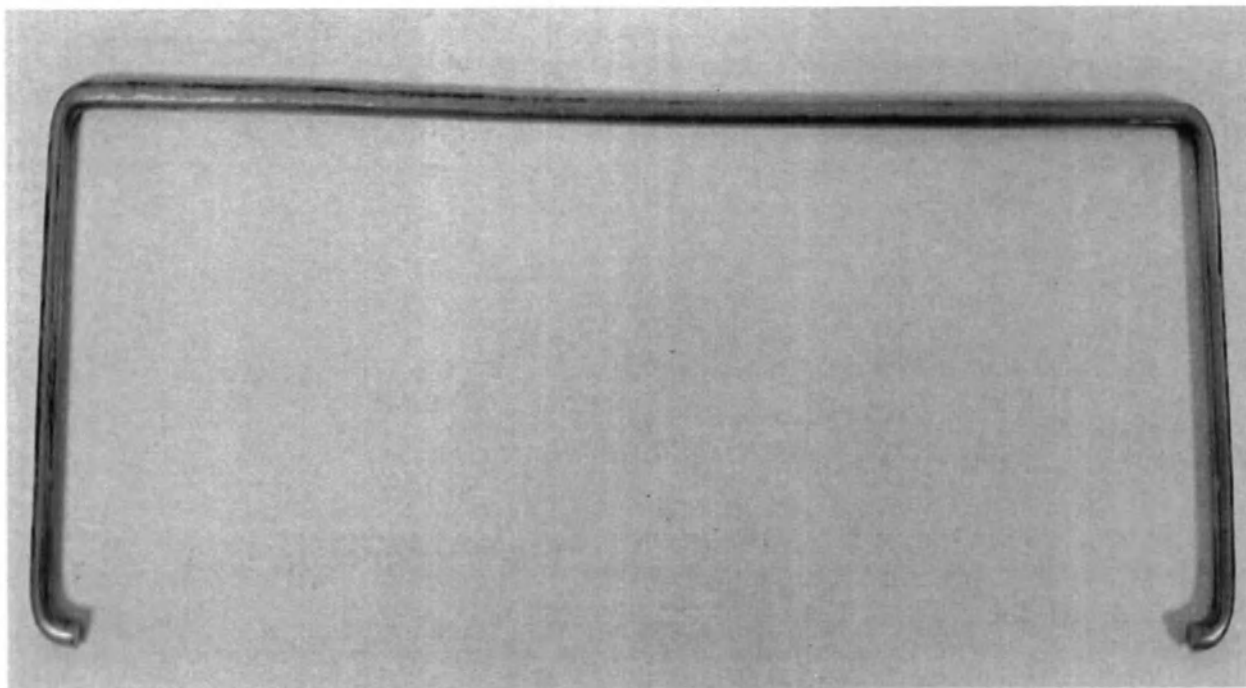


7) Держатель для корзин, арт. 41000504

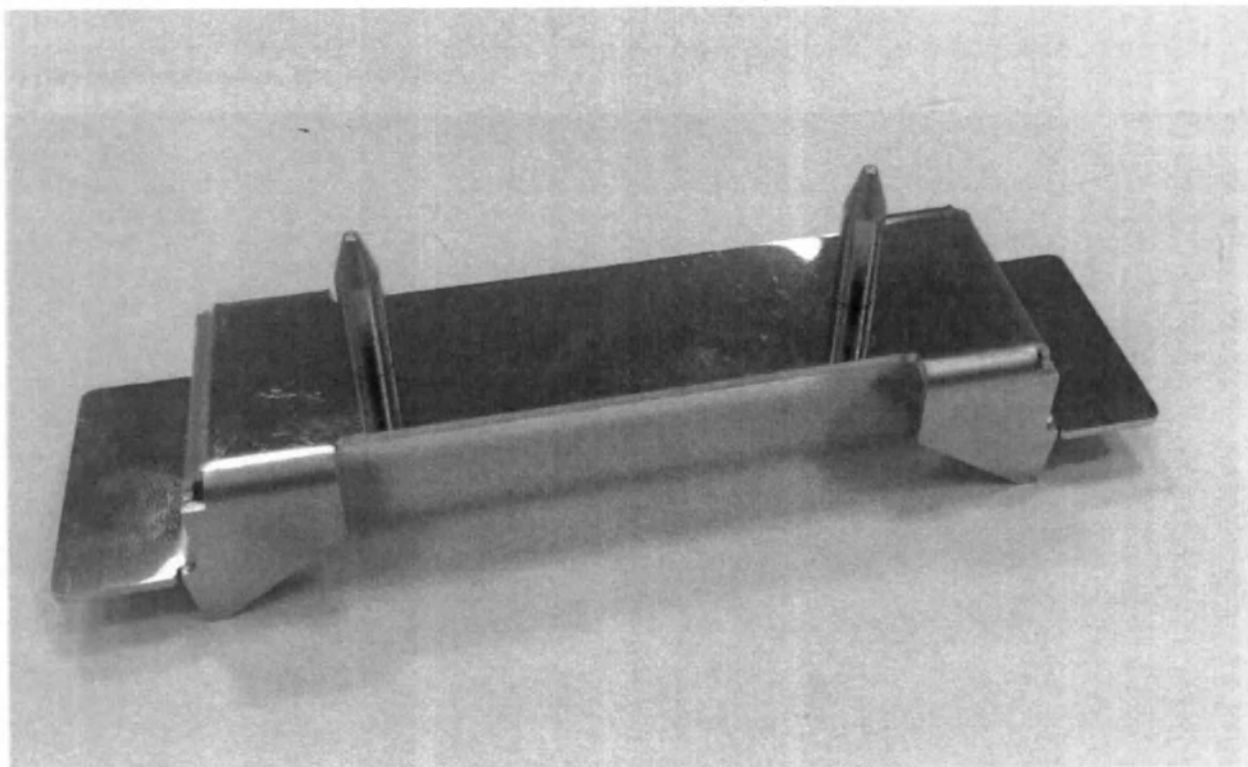

8) Корзина для предметных стекол, арт. 41000420

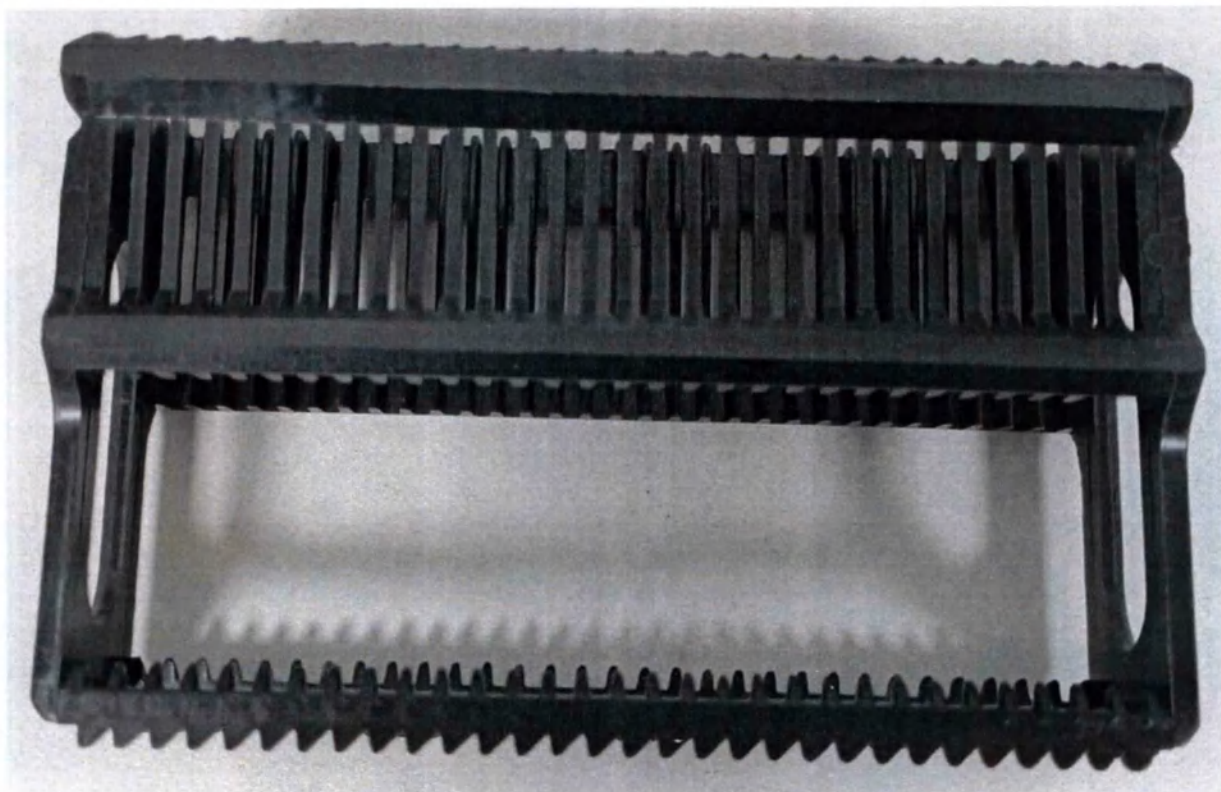

9) Впускной патрубок, арт. 41000655

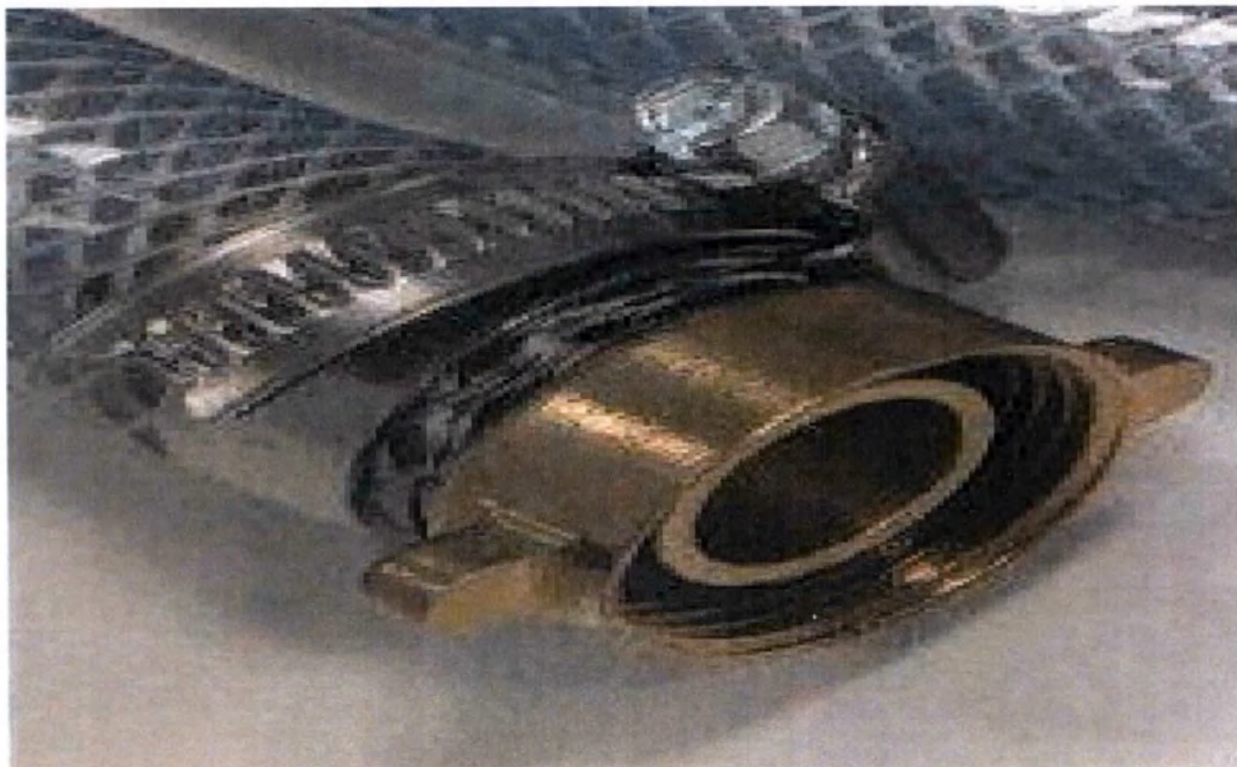


10) Шланг для подачи воды, 3 м., арт. 41000667



11) Сливной шланг, 2 м., арт. 41000657




12) Зажим для шланга фиксированный, арт. 33010428

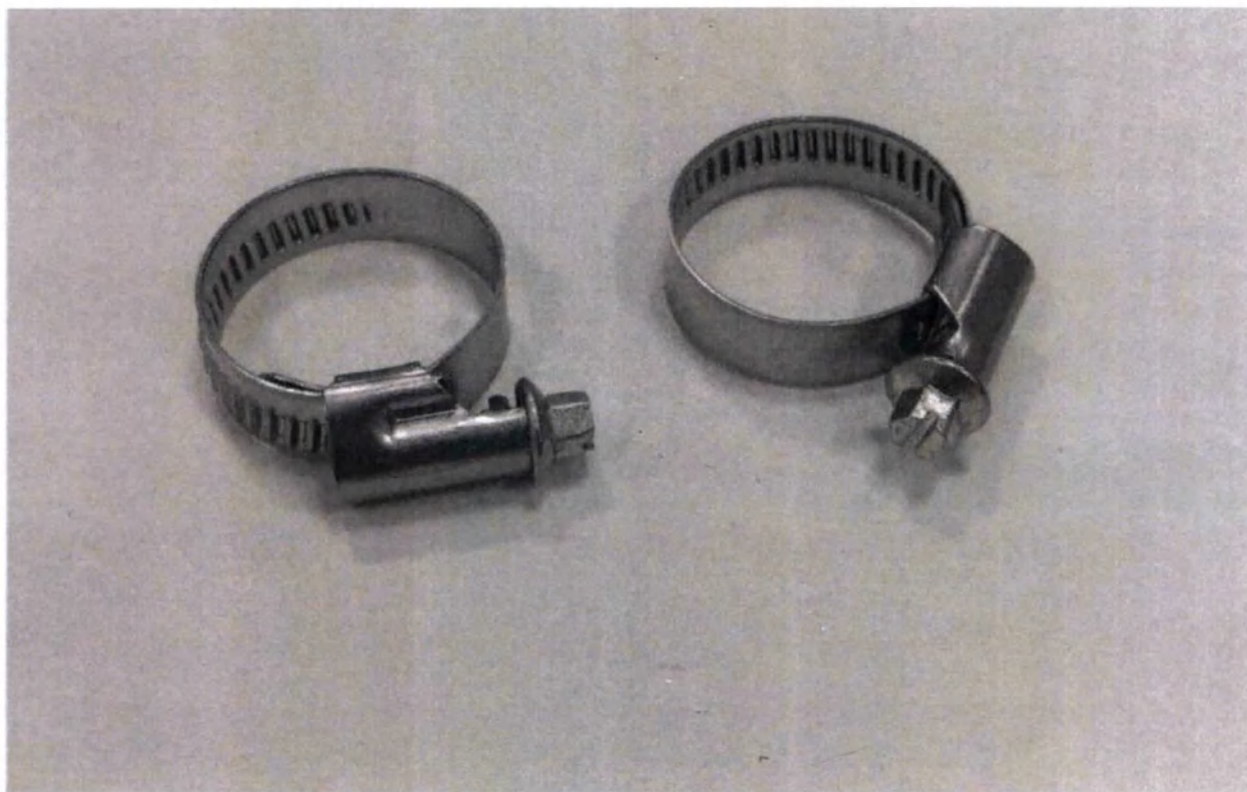


13) Переходник $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ дюйма, арт. 41000654




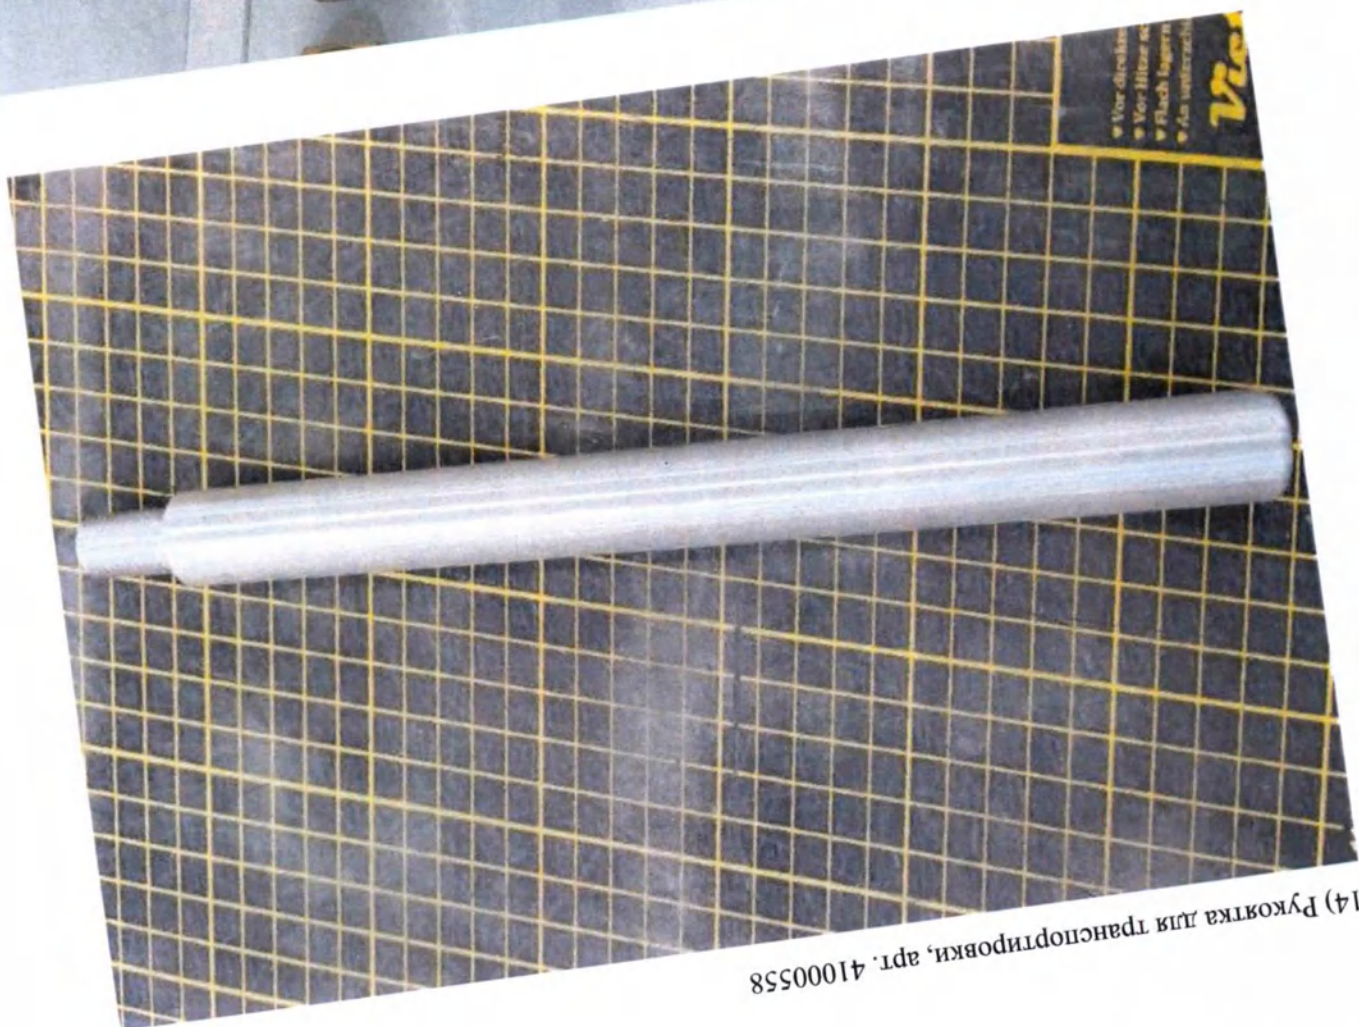

15) Фильтрующая прокладка для станции сушки, арт. 41000767

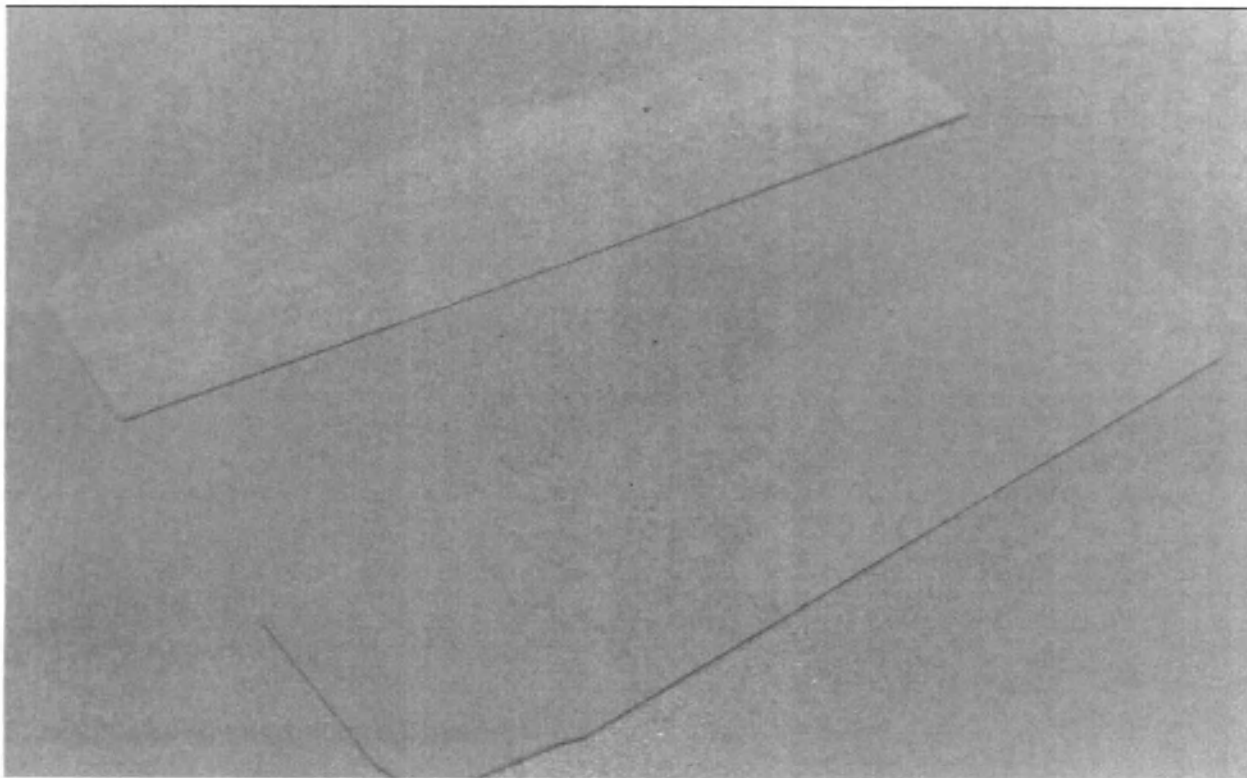

16) Угольный фильтр, арт. 41000020

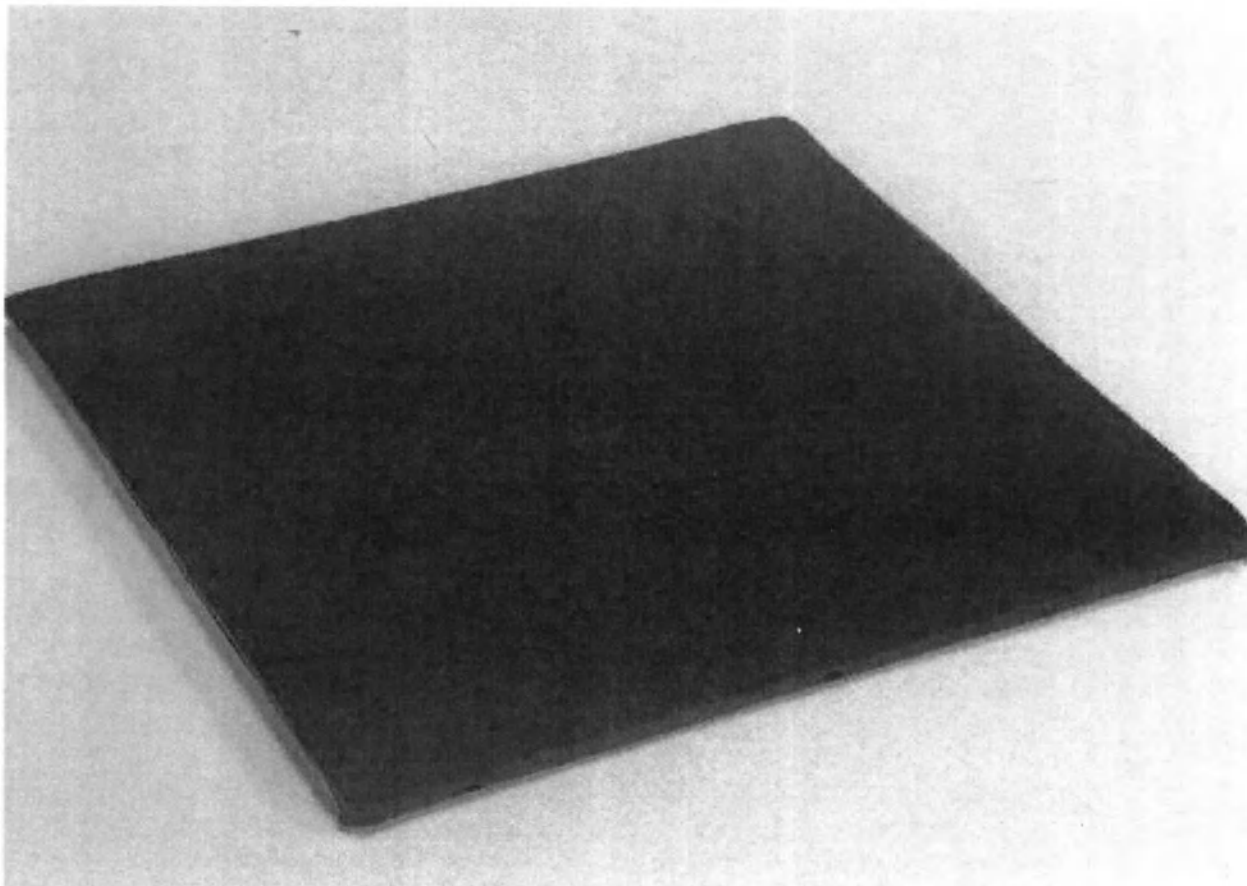

3. Шильдик медицинского изделия

Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec I, арт. 17000000



Стейнер автоматический для окраски гистологических микропрепаратов Cromatec II, арт. 17000001



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
20 ЛИСТА(ОВ)

Генеральный директор
ООО "БиоВитрум"
Заводовский Д.В.



18