



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ - ИСТ"

ОГРН 1067746682684
ИНН 7743598665
КПП 774301001
8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27, 745-63-18, 745-63-16, 745-63-20
Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А
sales@dental-east.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ»

Афанасьев А.Н.

«10» ноября 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки
моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в
вариантах исполнения**

Москва
2022





	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения		
<u>BRONZE DENTURE</u> (Вариант исполнения)		
	ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ" Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А	
Артикул <u>02045</u>		
SN <u> </u>	 +35 +10	
Дата изготовления/годен до 14.04.2021 / 04.2031	РУ № <u> </u> от <u>€ </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г	
Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С. Хранить при температуре от +10 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.		

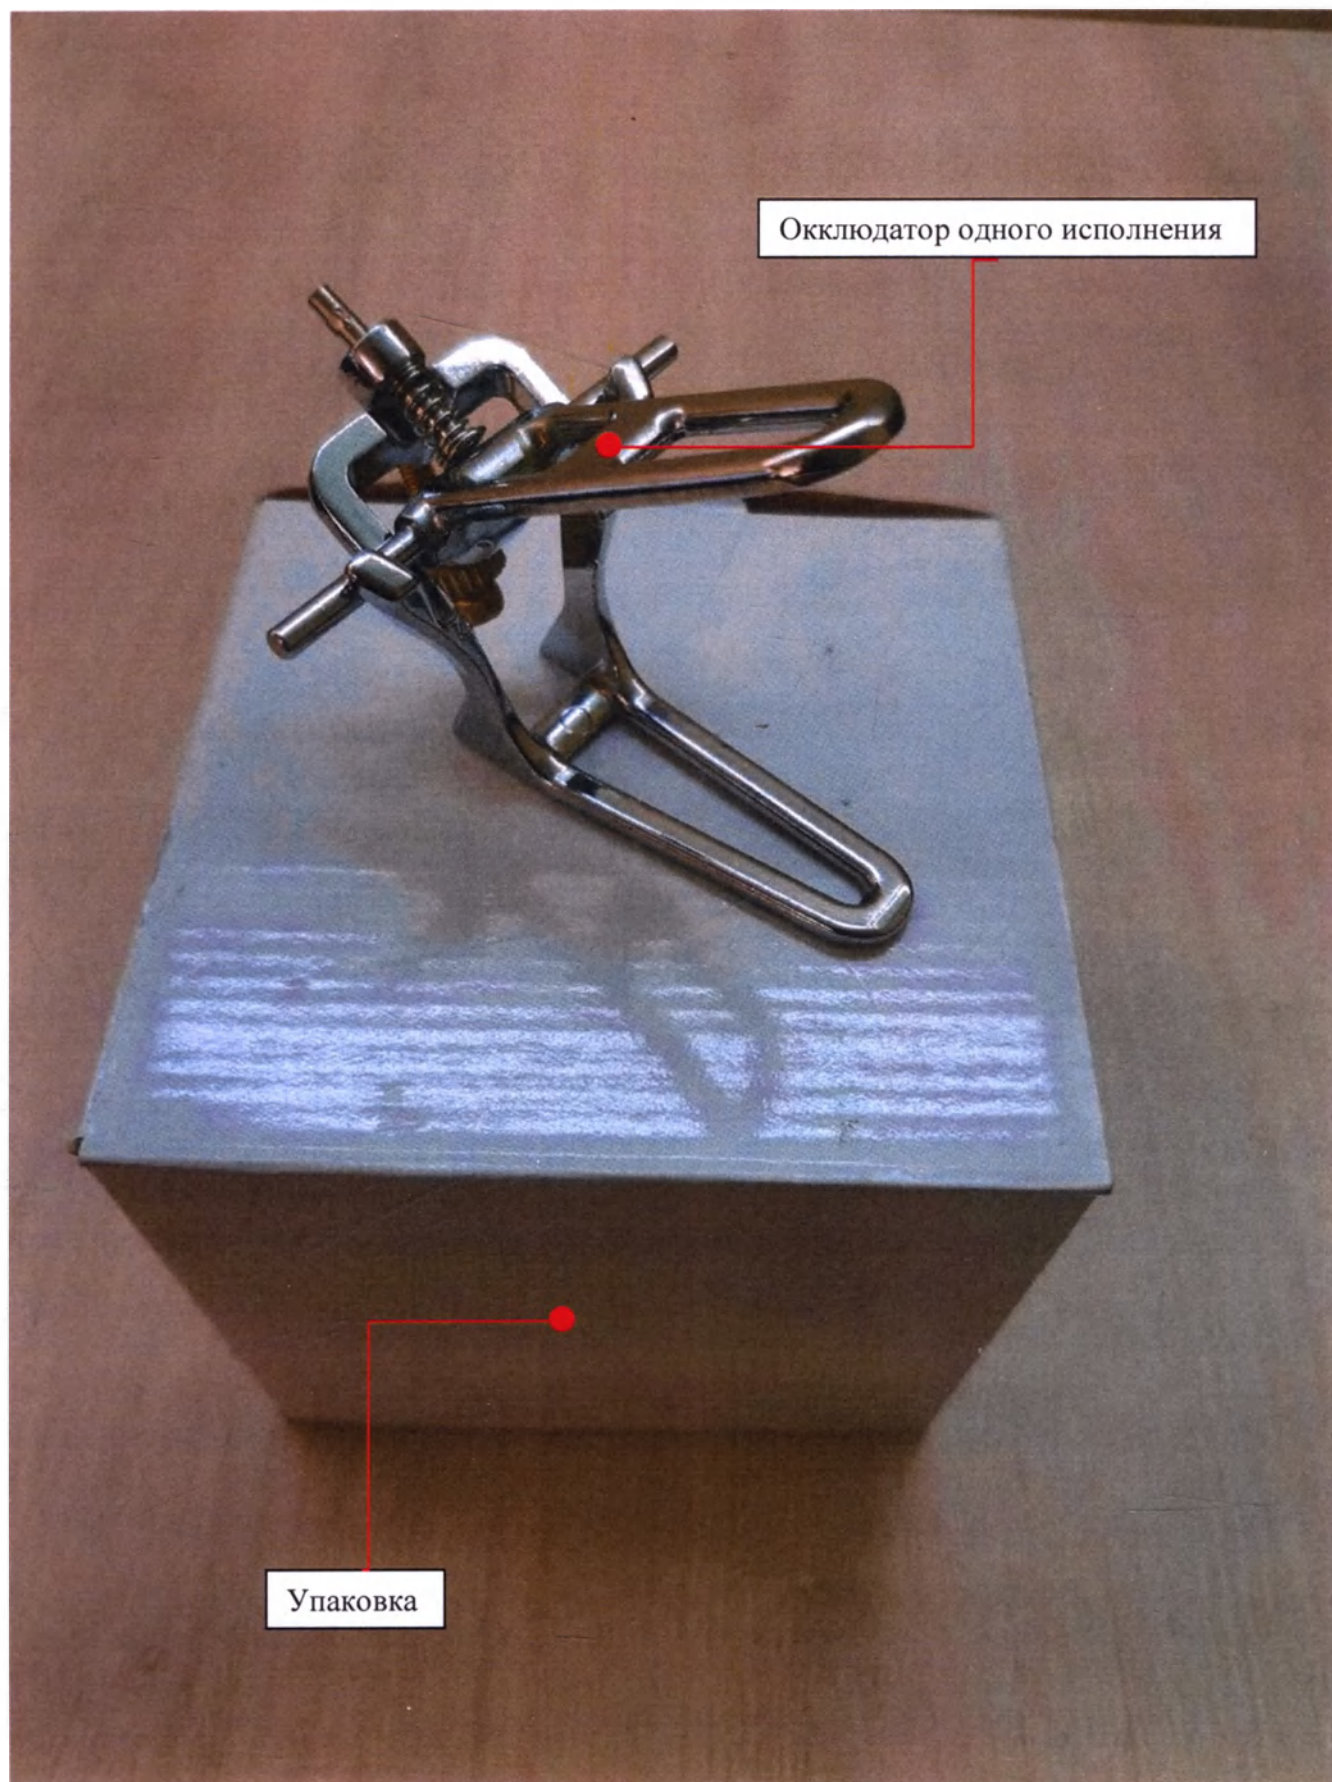

Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture C&B



Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture C&B

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения <i>Chrome Denture C&B</i> (Вариант исполнения)		
	ООО "ДЕНТАЛ - ИСТ" Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А	
Артикул <u>02044</u>		
SN <u> </u>	ПУ № <u> </u> от « <u> </u> » <u>20</u> г	
Дата изготовления/годен до 14.04.2021 / 04.2031	Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С Хранить при температуре от +10 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.	

Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture High Arch

Окклюдатор одного исполнения




Упаковка

Окклюдатор Labo-Mate Chrome Denture High Arch



	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения		
<u>Chrome Denture High Arch</u> (Вариант исполнения)		
	ООО «ДЕНТАЛ - ИСТ» Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А	
Артикул 02042		
SN	РУ № _____ от « _____ » 20__ г	 +35 +10
Дата изготовления/годен до 14.04.2021 / 04.2031		Транспортировать при температуре от -50 °C до +50 °C при влажности не более 80% при +25 °C Хранить при температуре от +10 °C до +35 °C при влажности не более 80% при +25 °C

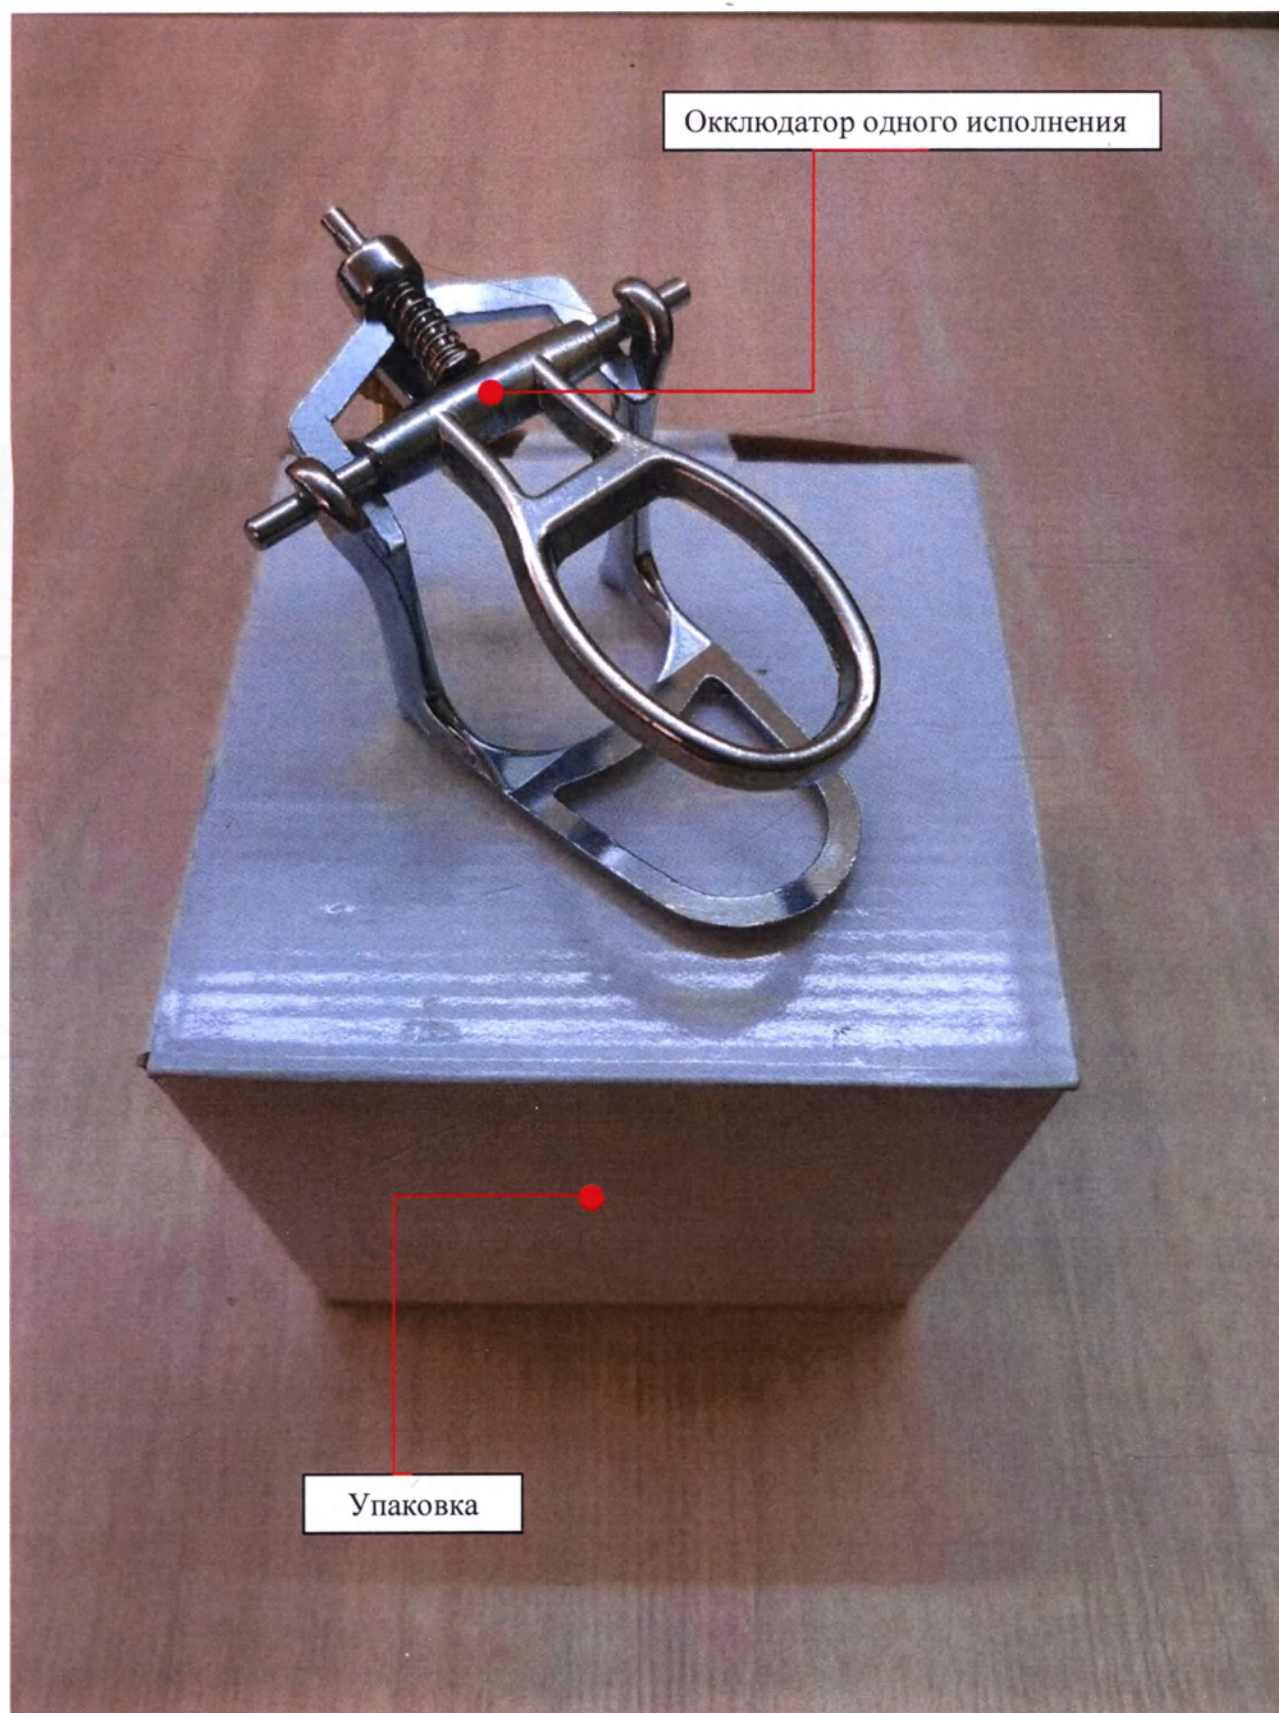

Окклюдатор одного исполнения

Упаковка



	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-2021, в вариантах исполнения <i>Chrome Denture Low Arch</i> (Вариант исполнения)		
	ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ» Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А	
Артикул <u>02043</u>		+35 +10
SN _____	PV № _____ от « _____ » 20__ г	
Дата изготовления/годен до 14.04.2021 / 04.2031	Транспортировать при температуре от -50 °C до +50 °C при влажности не более 80% при +25 °C Хранить при температуре от +10 °C до +35 °C при влажности не более 80% при +25 °C	

Сшито и заверено печатью 13

Григорьев лист 26

Директор
ООО «ДЕНТАЛ - ИСТ»
Афанасьев А.Н.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕНТАЛ - ИСТ"

ОГРН 1067746682684
ИНН 7743598665
КПП 774301001
8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27, 745-63-18, 745-63-16, 745-63-20
Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А
sales@dental-est.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор



**Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки
моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-95983703-
2021, в вариантах исполнения**

**Макет маркировки
медицинского изделия**

Маркировка изделия

Артикул	02030
	

Маркировка упаковки изделия

		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-959837/03-2021, в вариантах исполнения			
(Вариант исполнения)			
 ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ» Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А			
Артикул			+10
SN	РУ № _____ от «___» _____ 20__ г.		
Дата изготовления/годен до Хх.хх.хх/хх.хх.хх	Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С. Хранить при температуре от +0 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.		

Маркировка упаковки транспортной тары

		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛ-ИСТ»	
Окклюдатор зуботехнический Labo-Mate для установки моделей зубных протезов по ТУ 32.50.11-002-959837/03-2021, в вариантах исполнения			
(Вариант исполнения)			
Наименование грузополучателя _____ (Полное или условное наименование в соответствии с классификацией грузополучателя) Наименование пункта назначения _____ Наименование грузоотправителя _____ (Полное или условное наименование в соответствии с классификацией грузоотправителя) Подписи транспортных организаций _____			
Число изделий: шт. _____ Брутто, кг _____ Габаритные размеры, мм _____ Гарантийный срок хранения - до _____			
		 +10  +35 	
		XX XX XXXX	
Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С при влажности не более 80% при +25 °С. Хранить при температуре от +13 °С до +35 °С при влажности не более 80% при +25 °С.			
 ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ» Юридический адрес: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А Адрес производства: Россия, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 96А			

Сшито и заверено печатью 2
() лист е

Директор
ООО «ДЕНТАЛ-ИСТ»
Афанасьев А.Н.

