

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГТЗ»



Адамян Л.А.

2024 г

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Блок базовый (Генетический анализатор (секвенатор) G08)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Блок базовый (Генетический анализатор (секвенатор) G16)




Блок базовый (Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**




Кабель питания (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

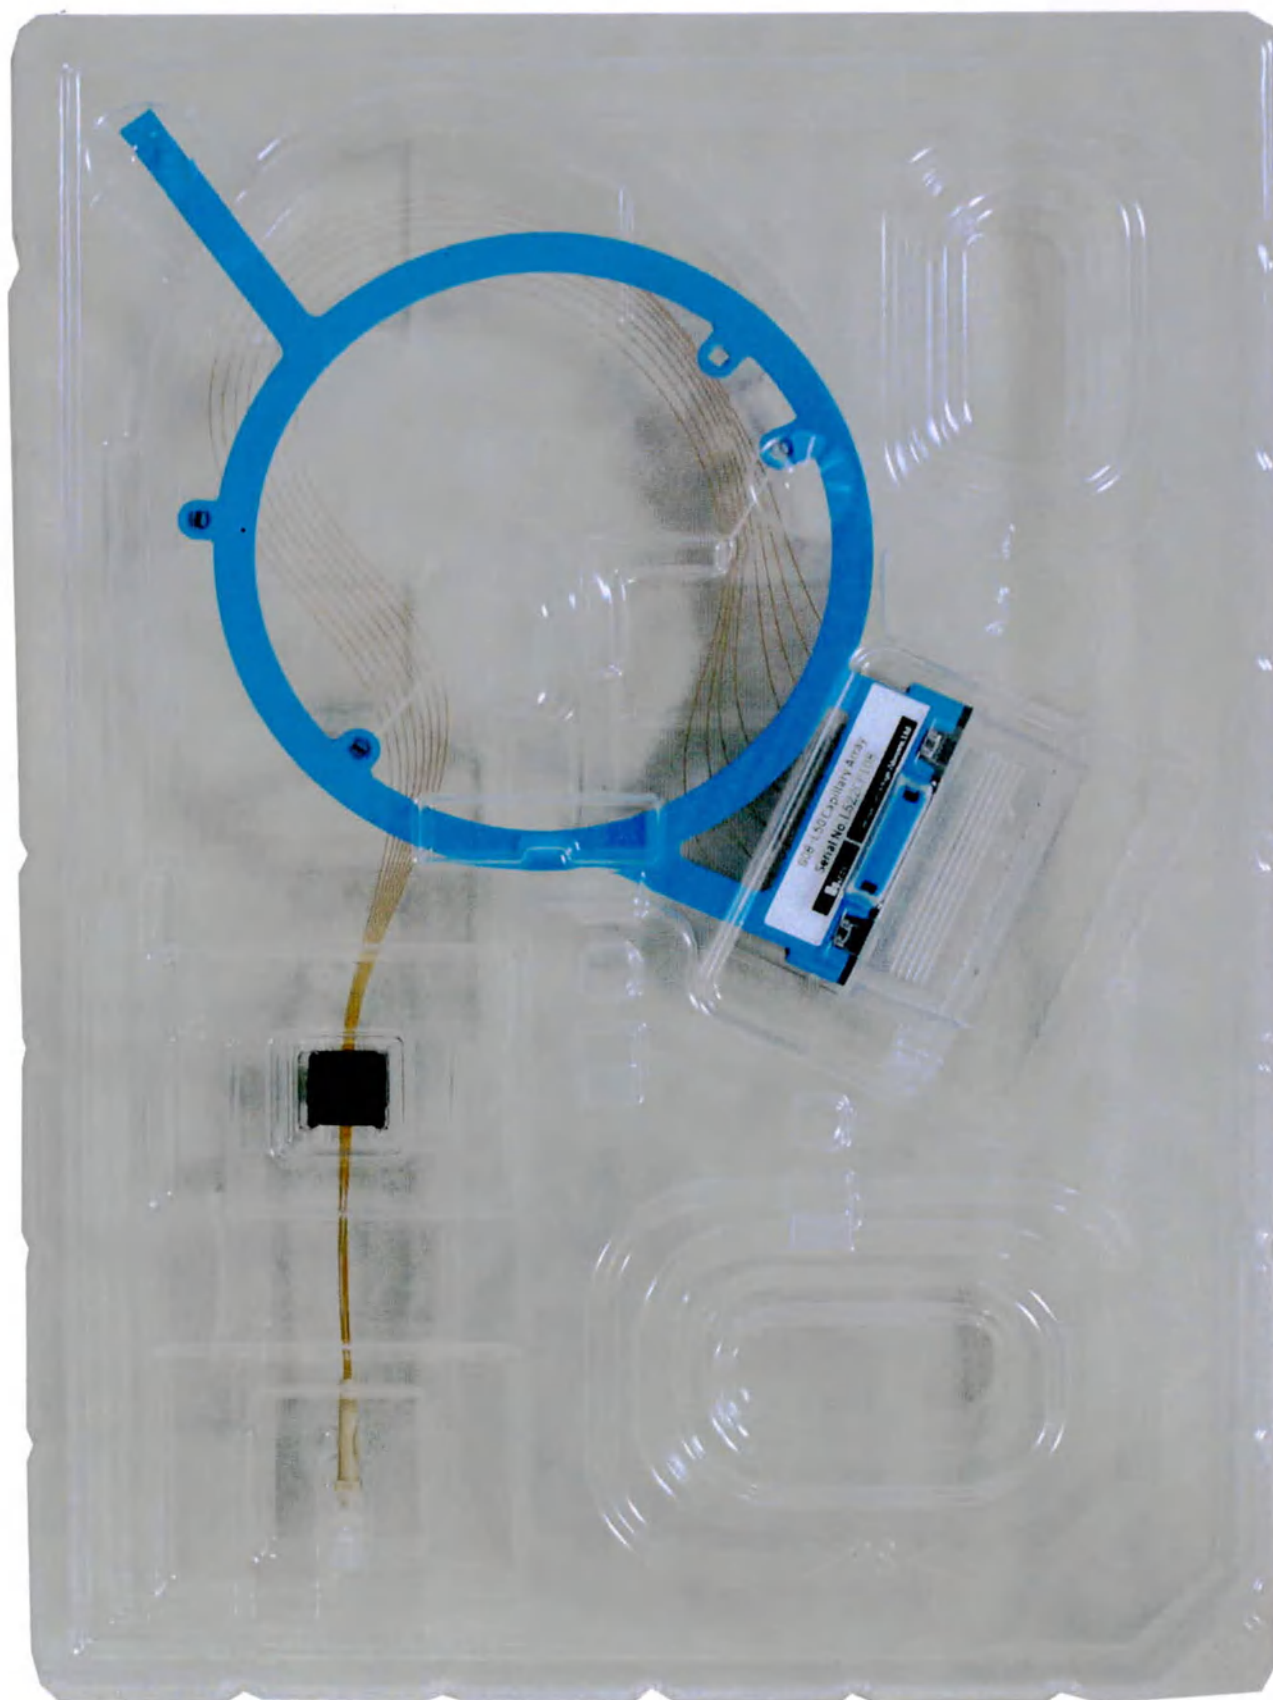


Картридж с капиллярами 8×50 см (Генетический анализатор (секвенатор) G08)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

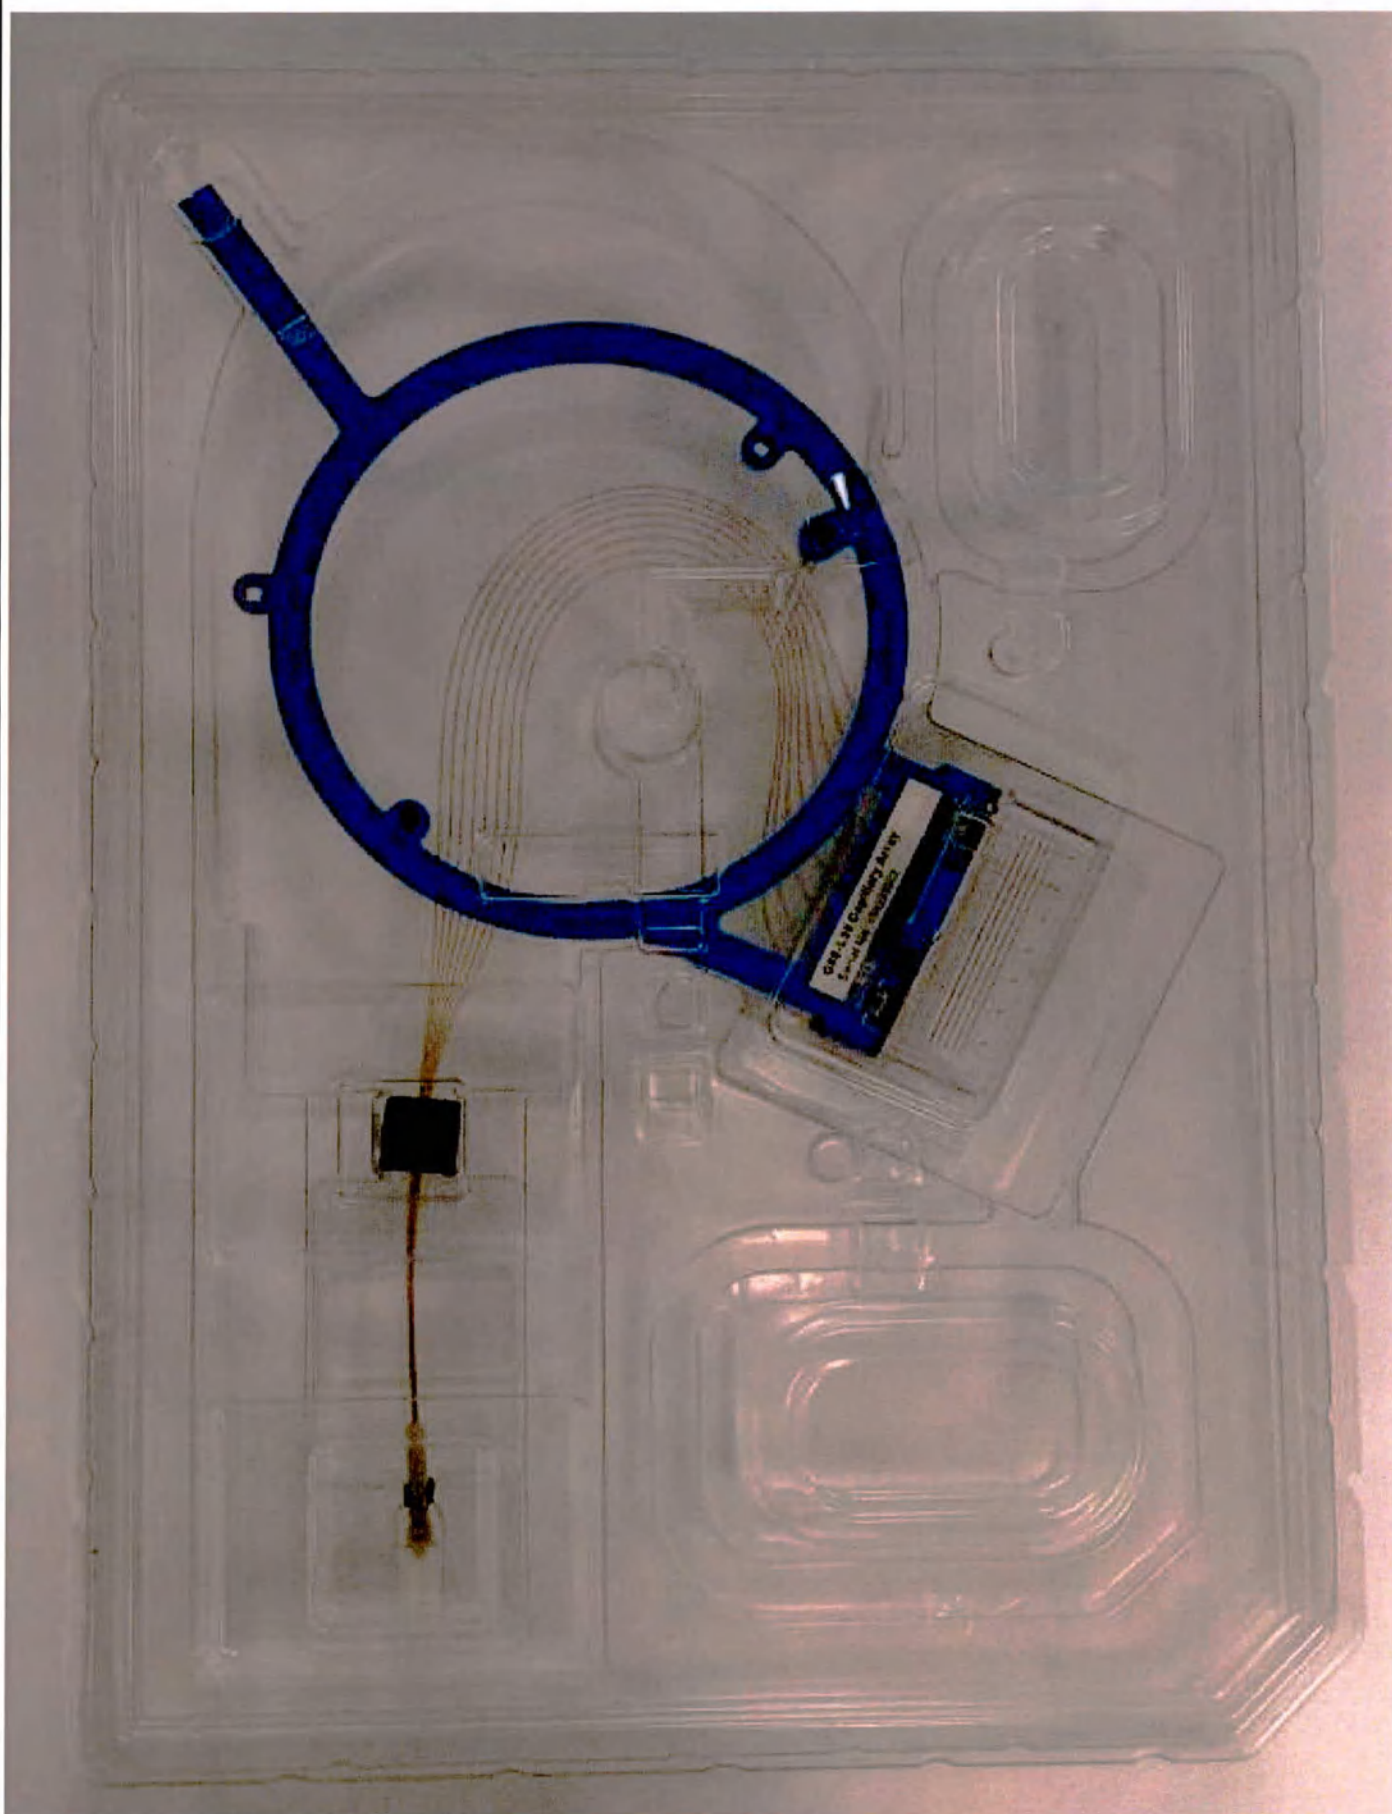


Картридж с капиллярами 8×36 см (Генетический анализатор (секвенатор) G08)


Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

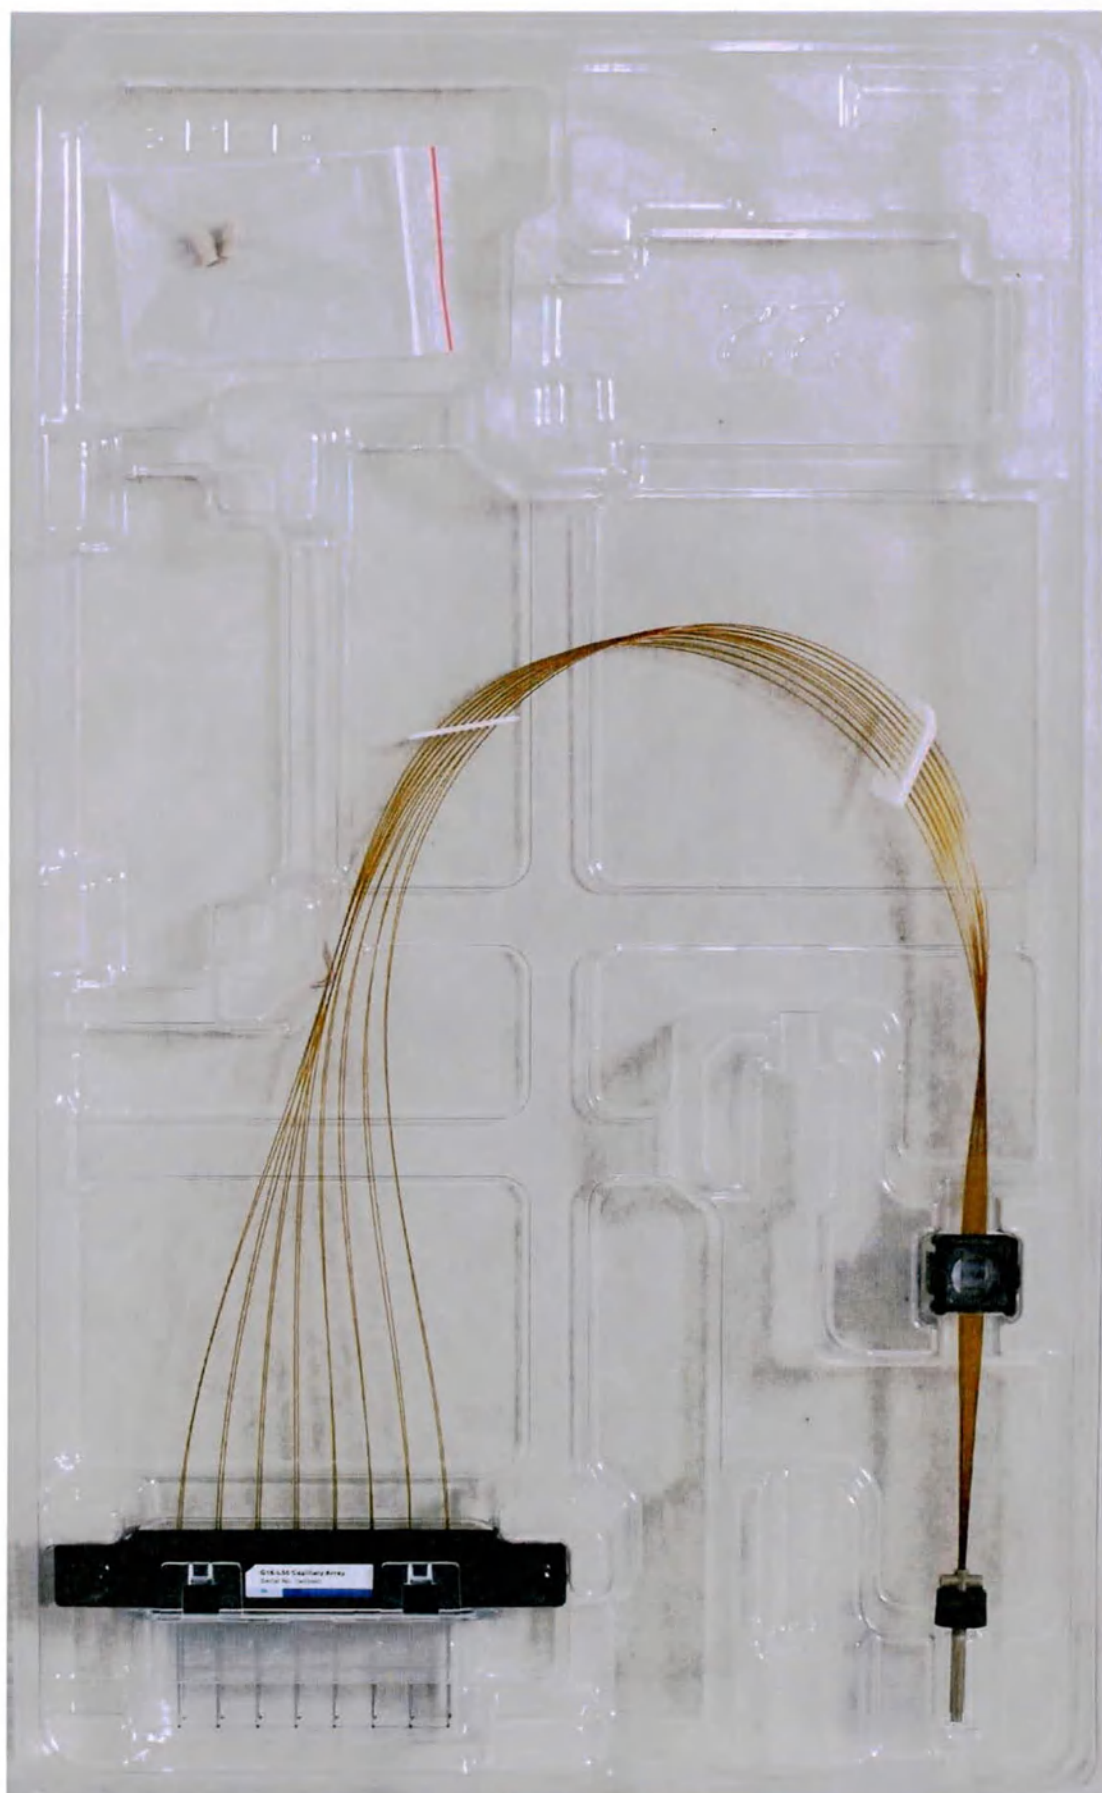

Картридж с капиллярами 16×50 см (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

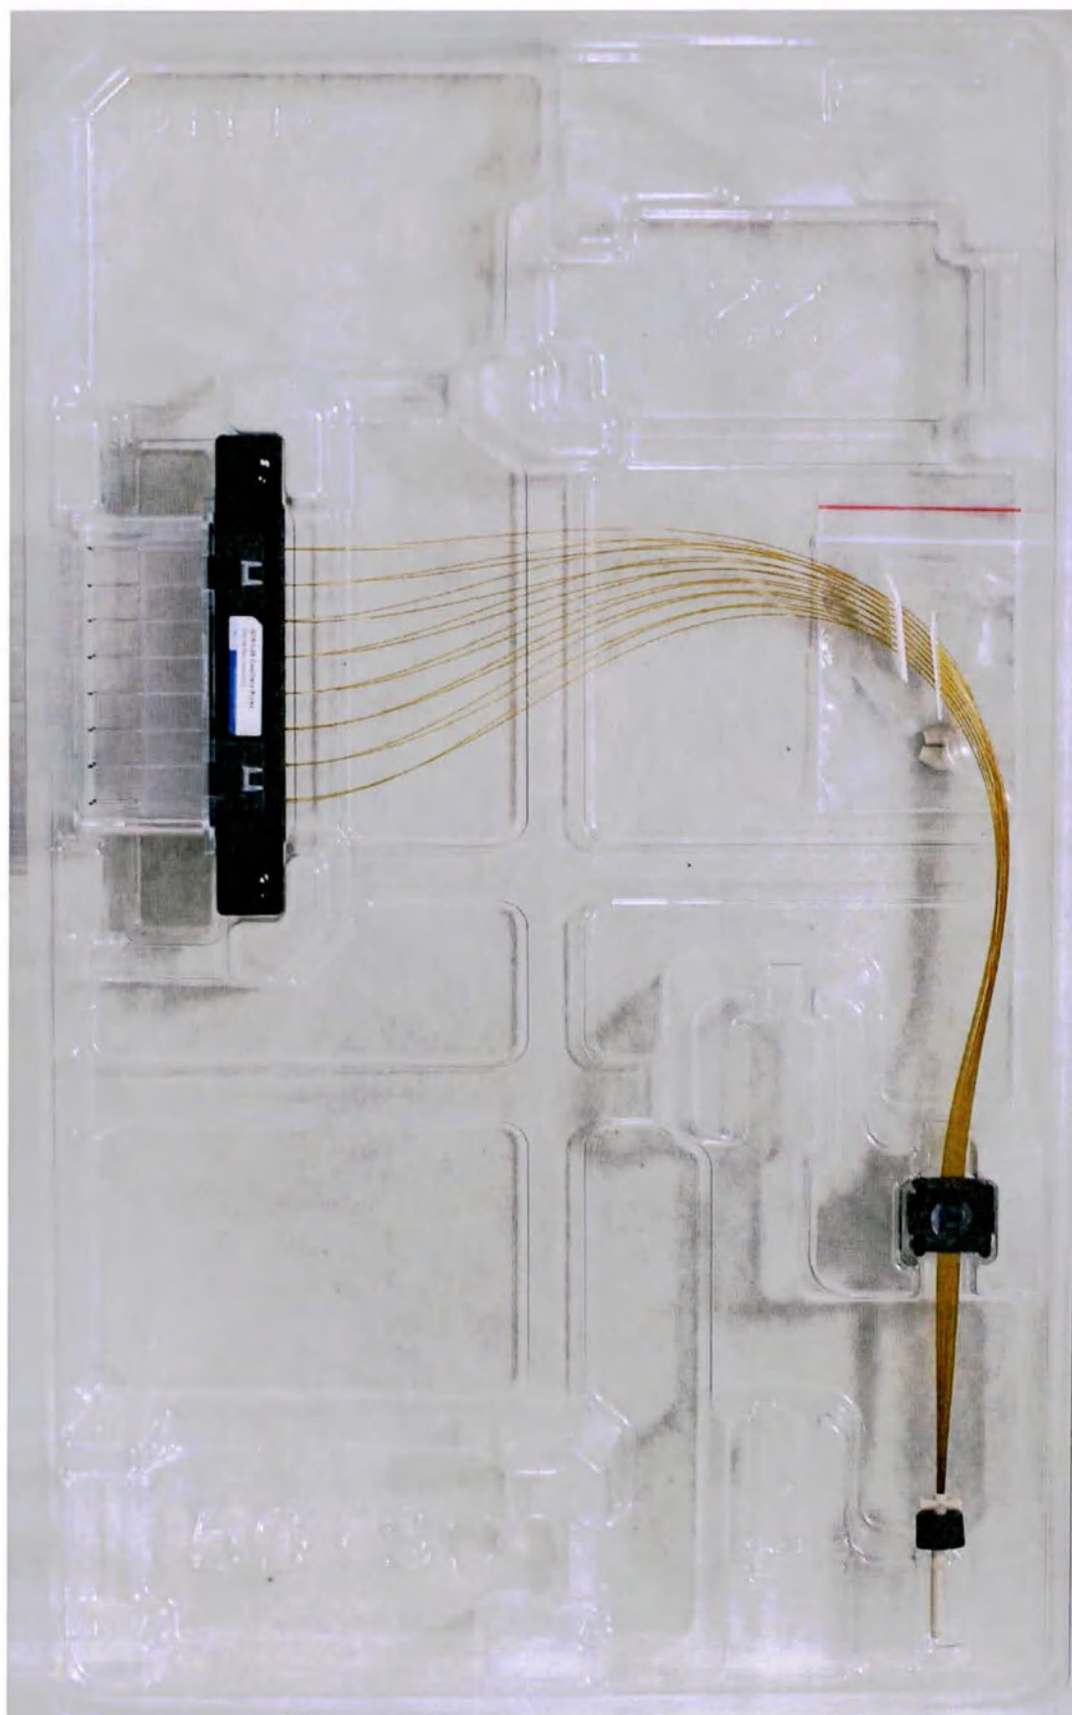


Картридж с капиллярами 16×36 см (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

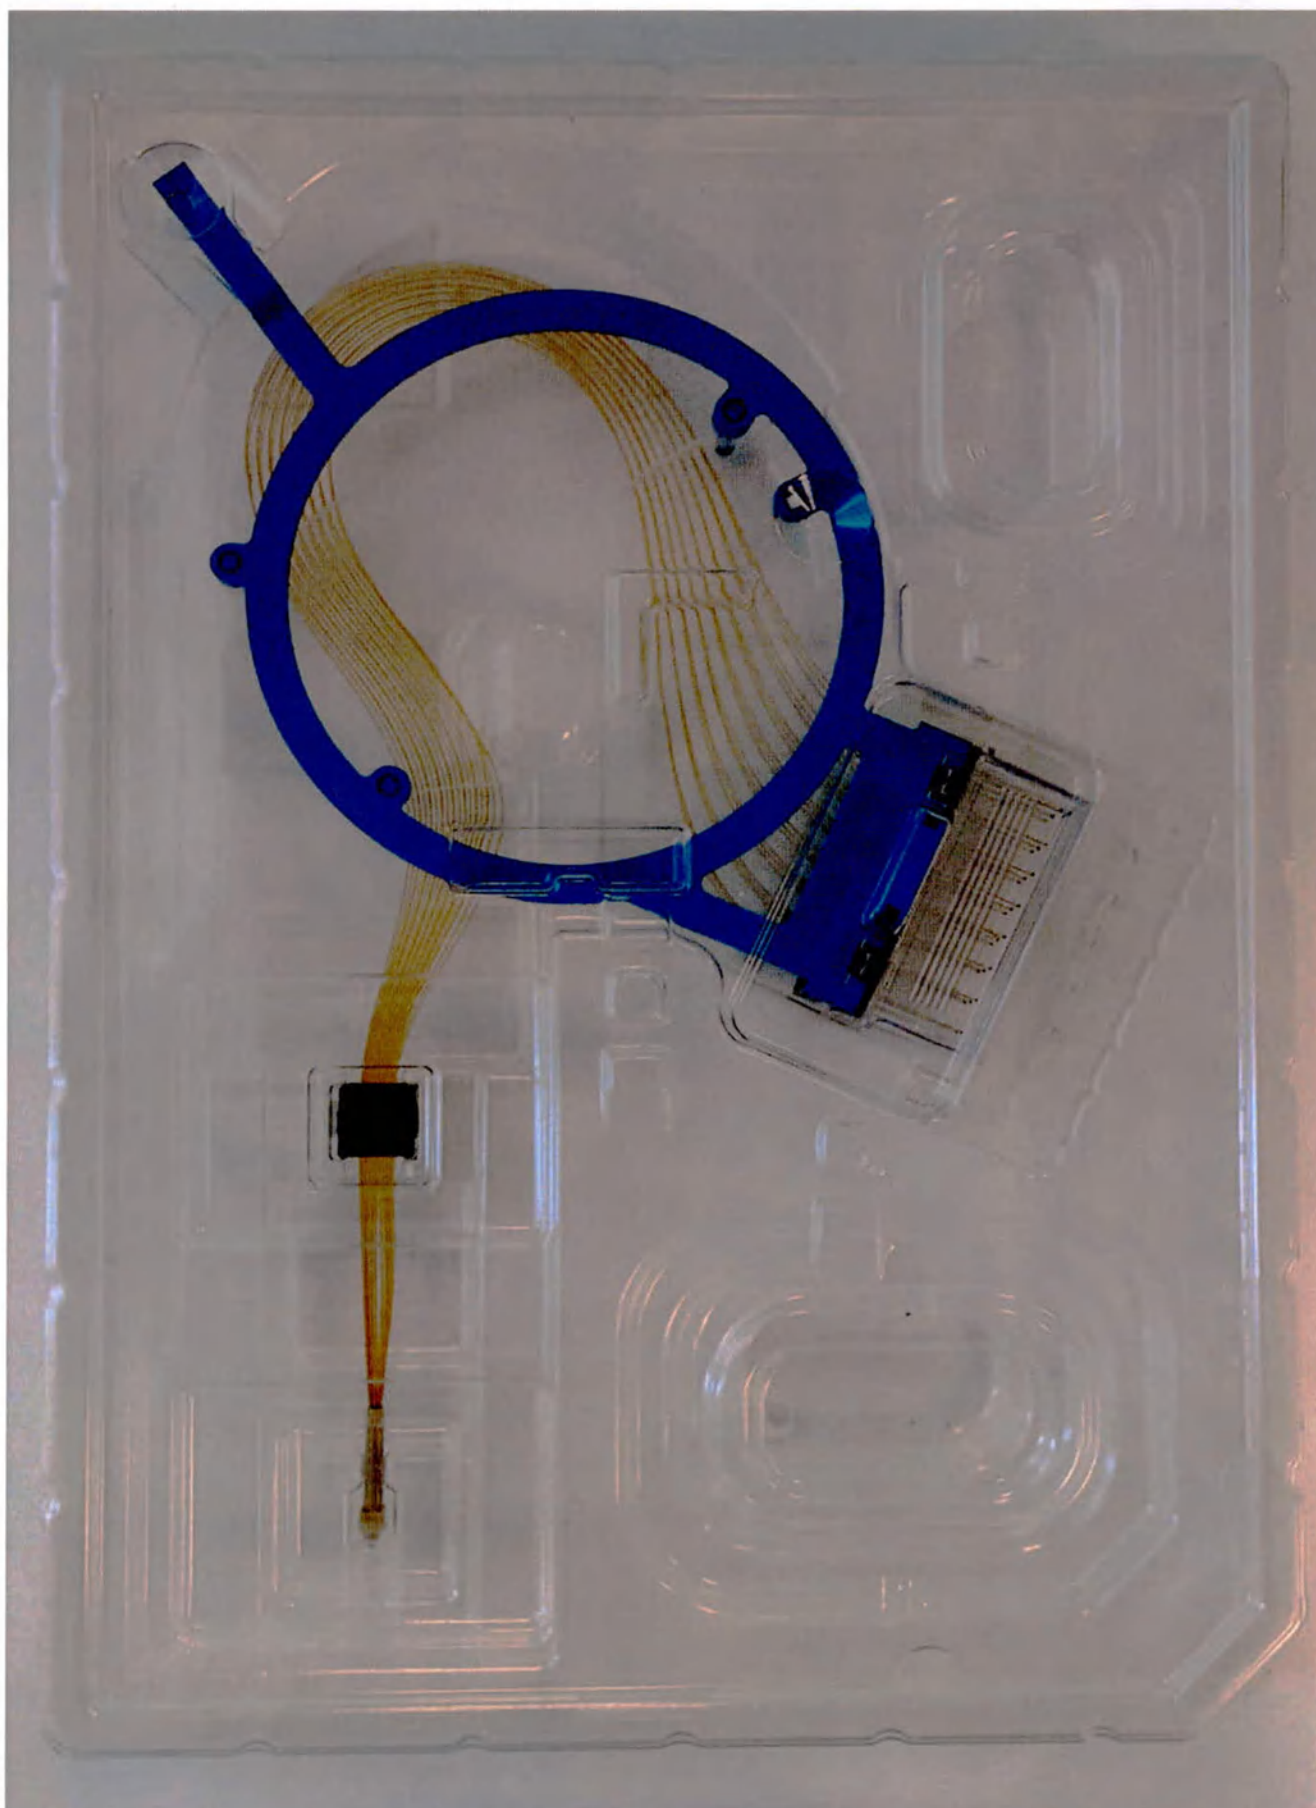

Картридж с капиллярами 24×50 см (Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

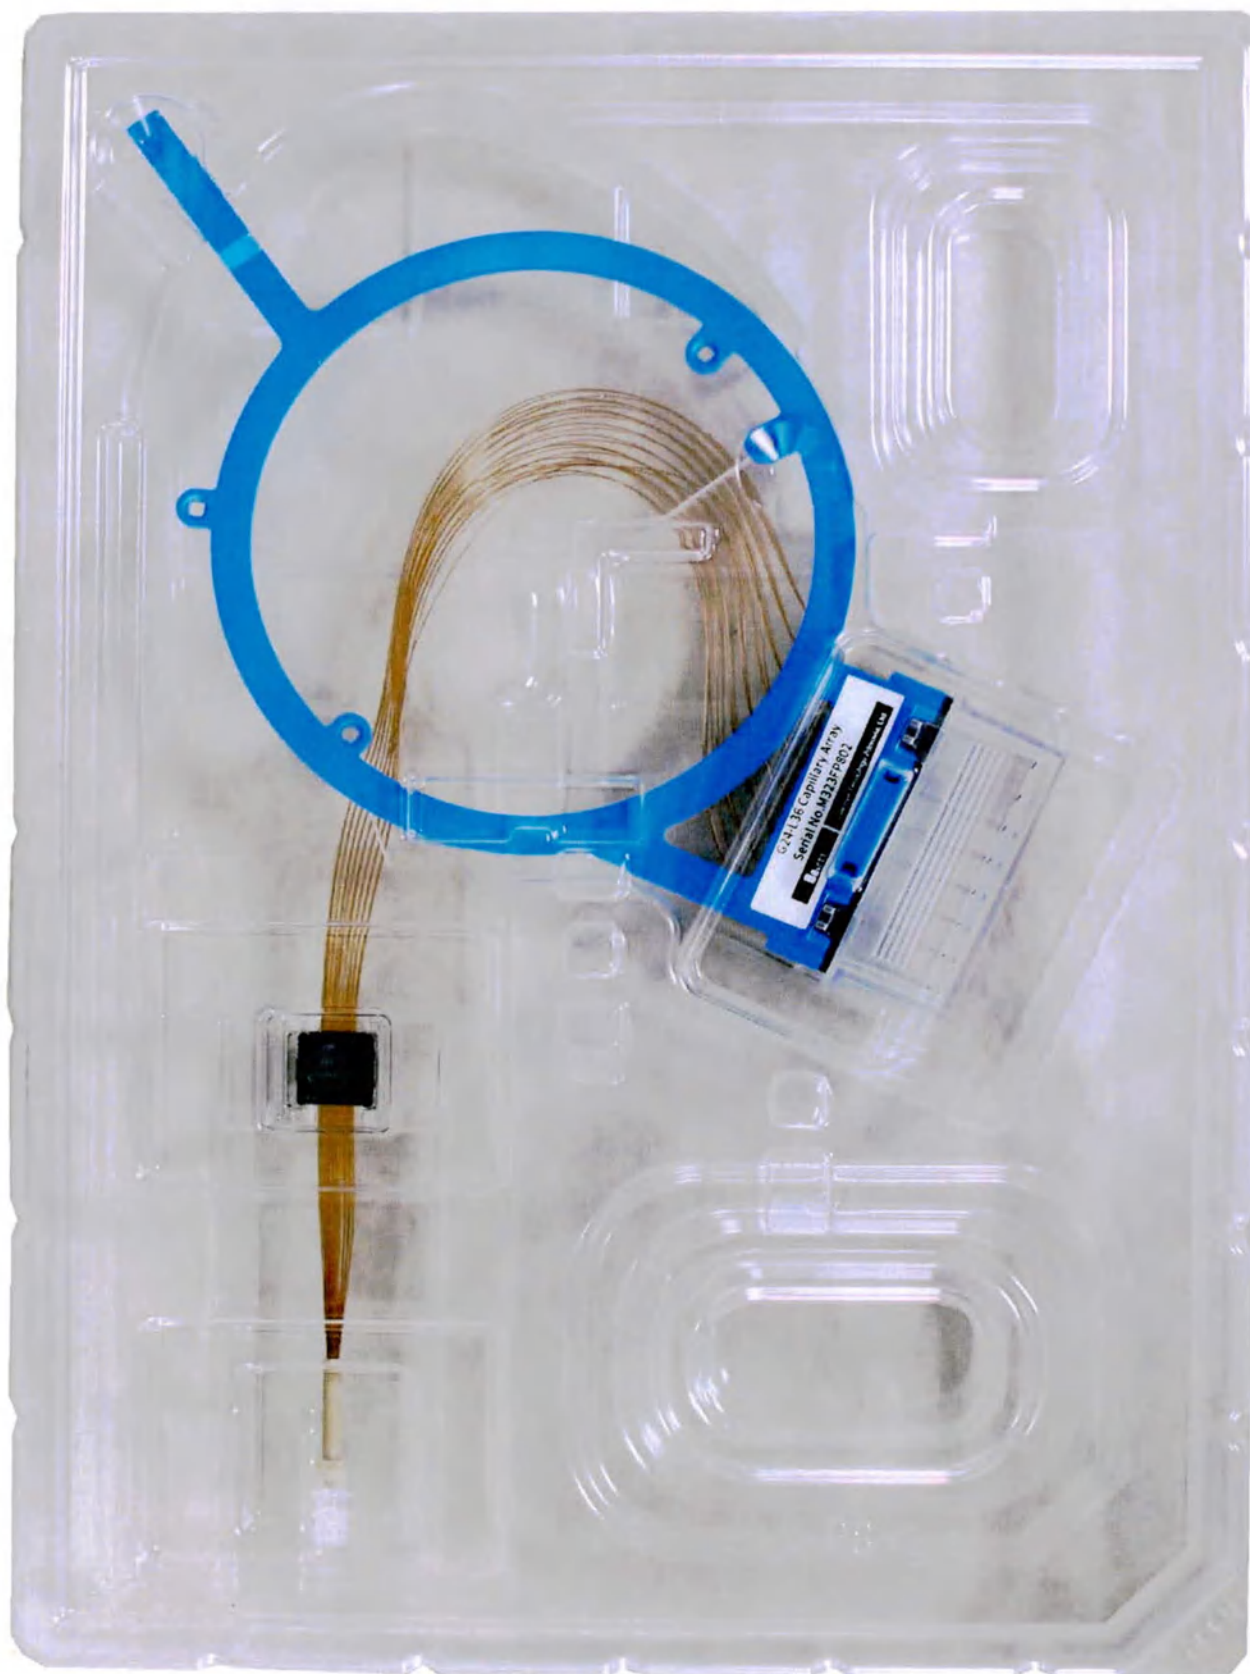


Картридж с капиллярами 24×36 см (Генетический анализатор (секвенатор) G24)


**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**



Фиксатор планшета 96-луночного (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

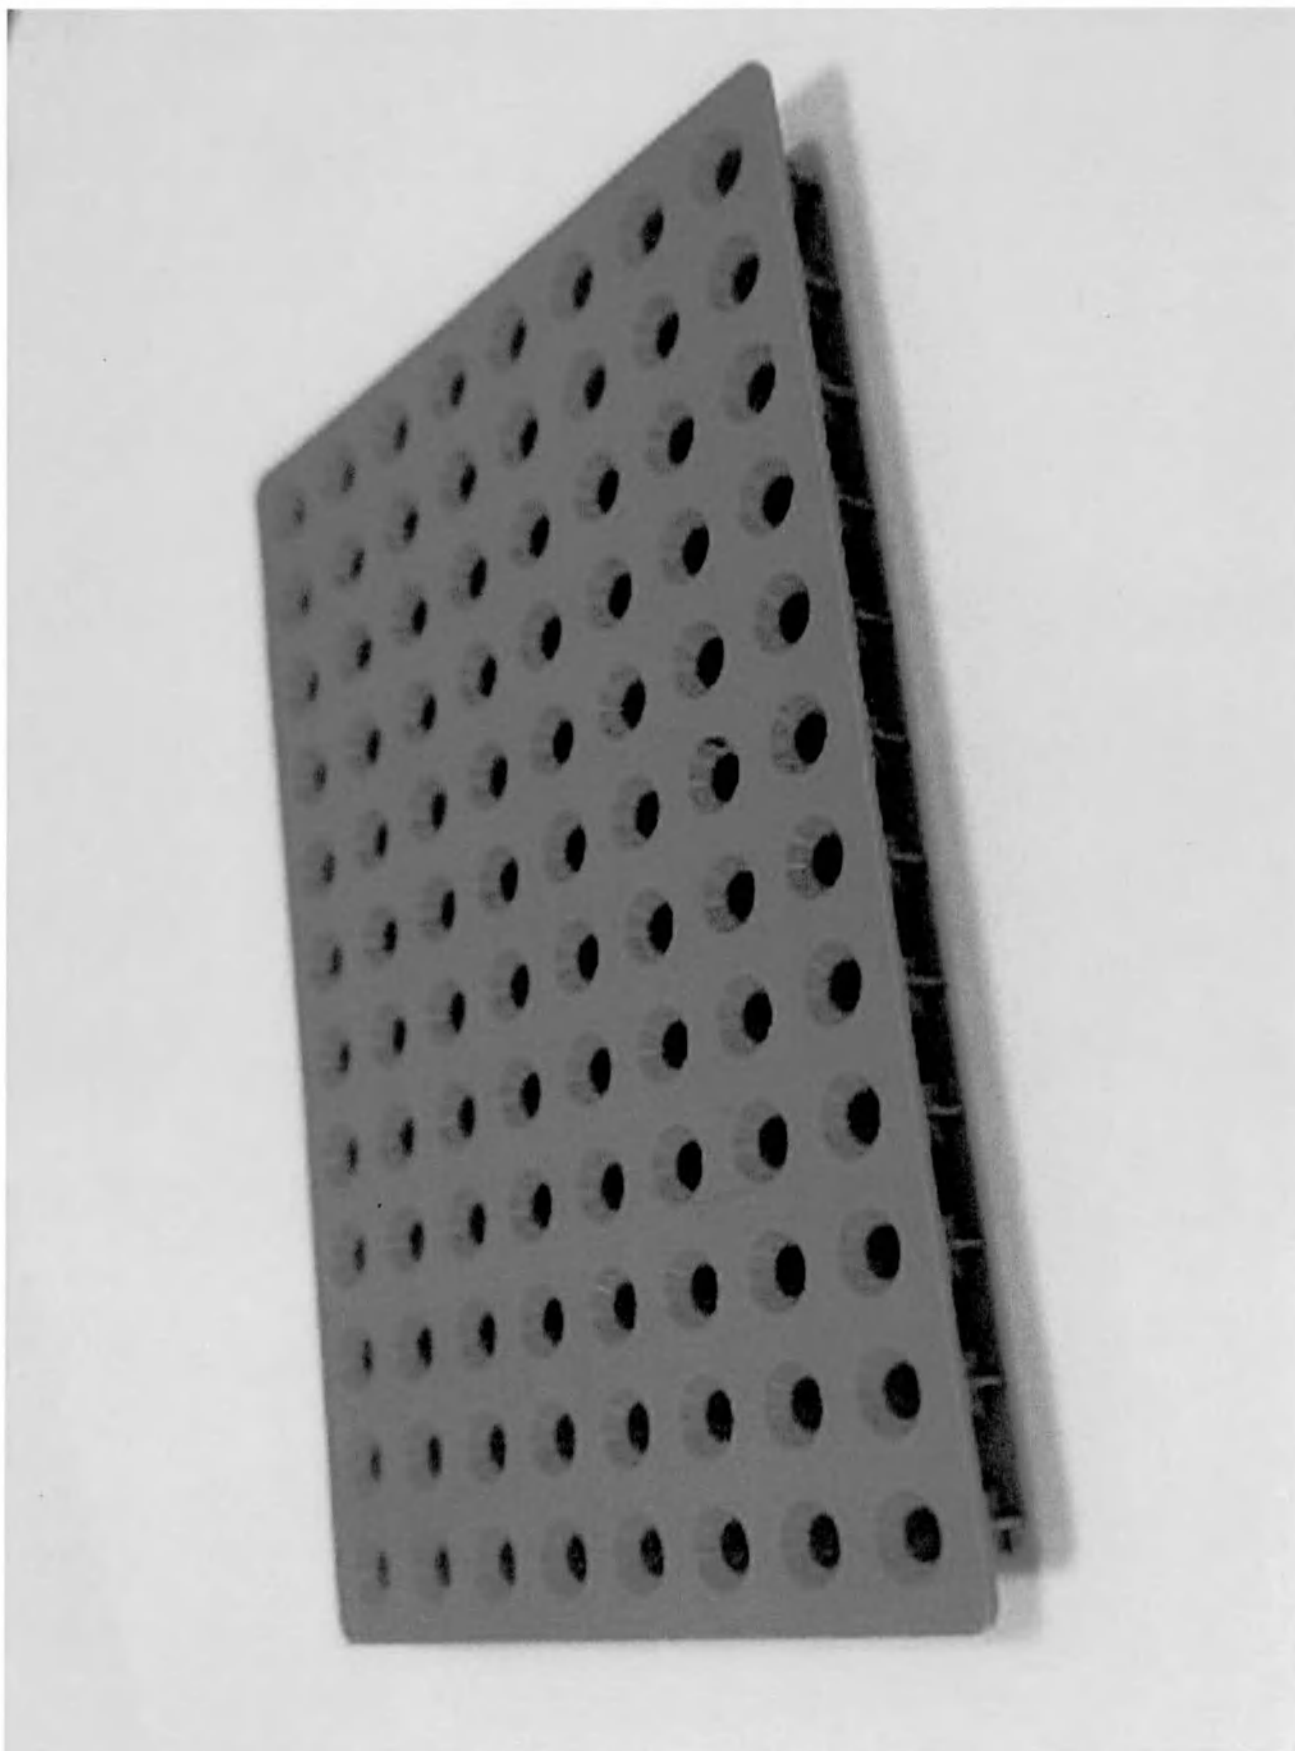


Антииспаритель (септа) для планшета 96-луночного (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

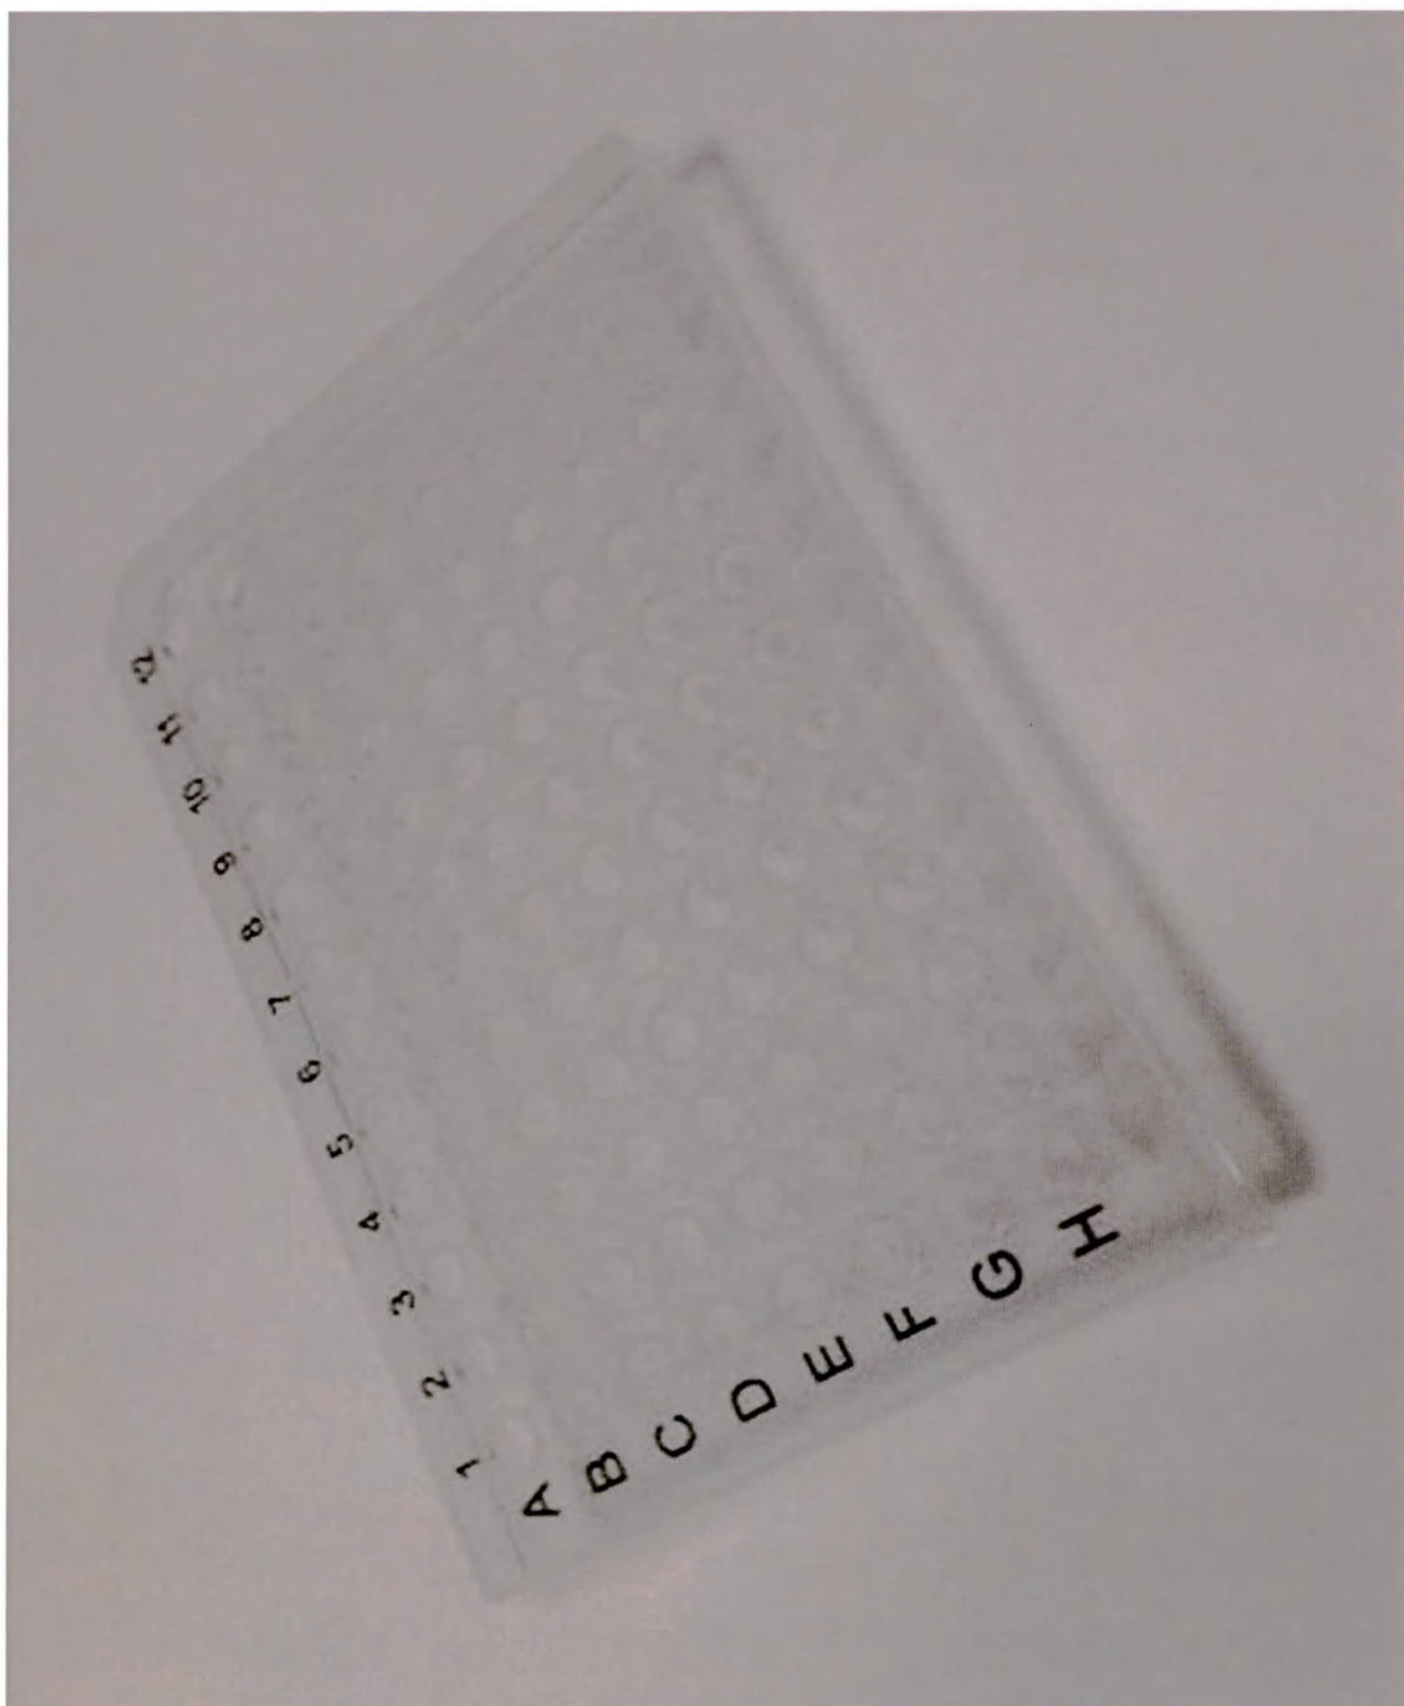

Планшет 96-луночный (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

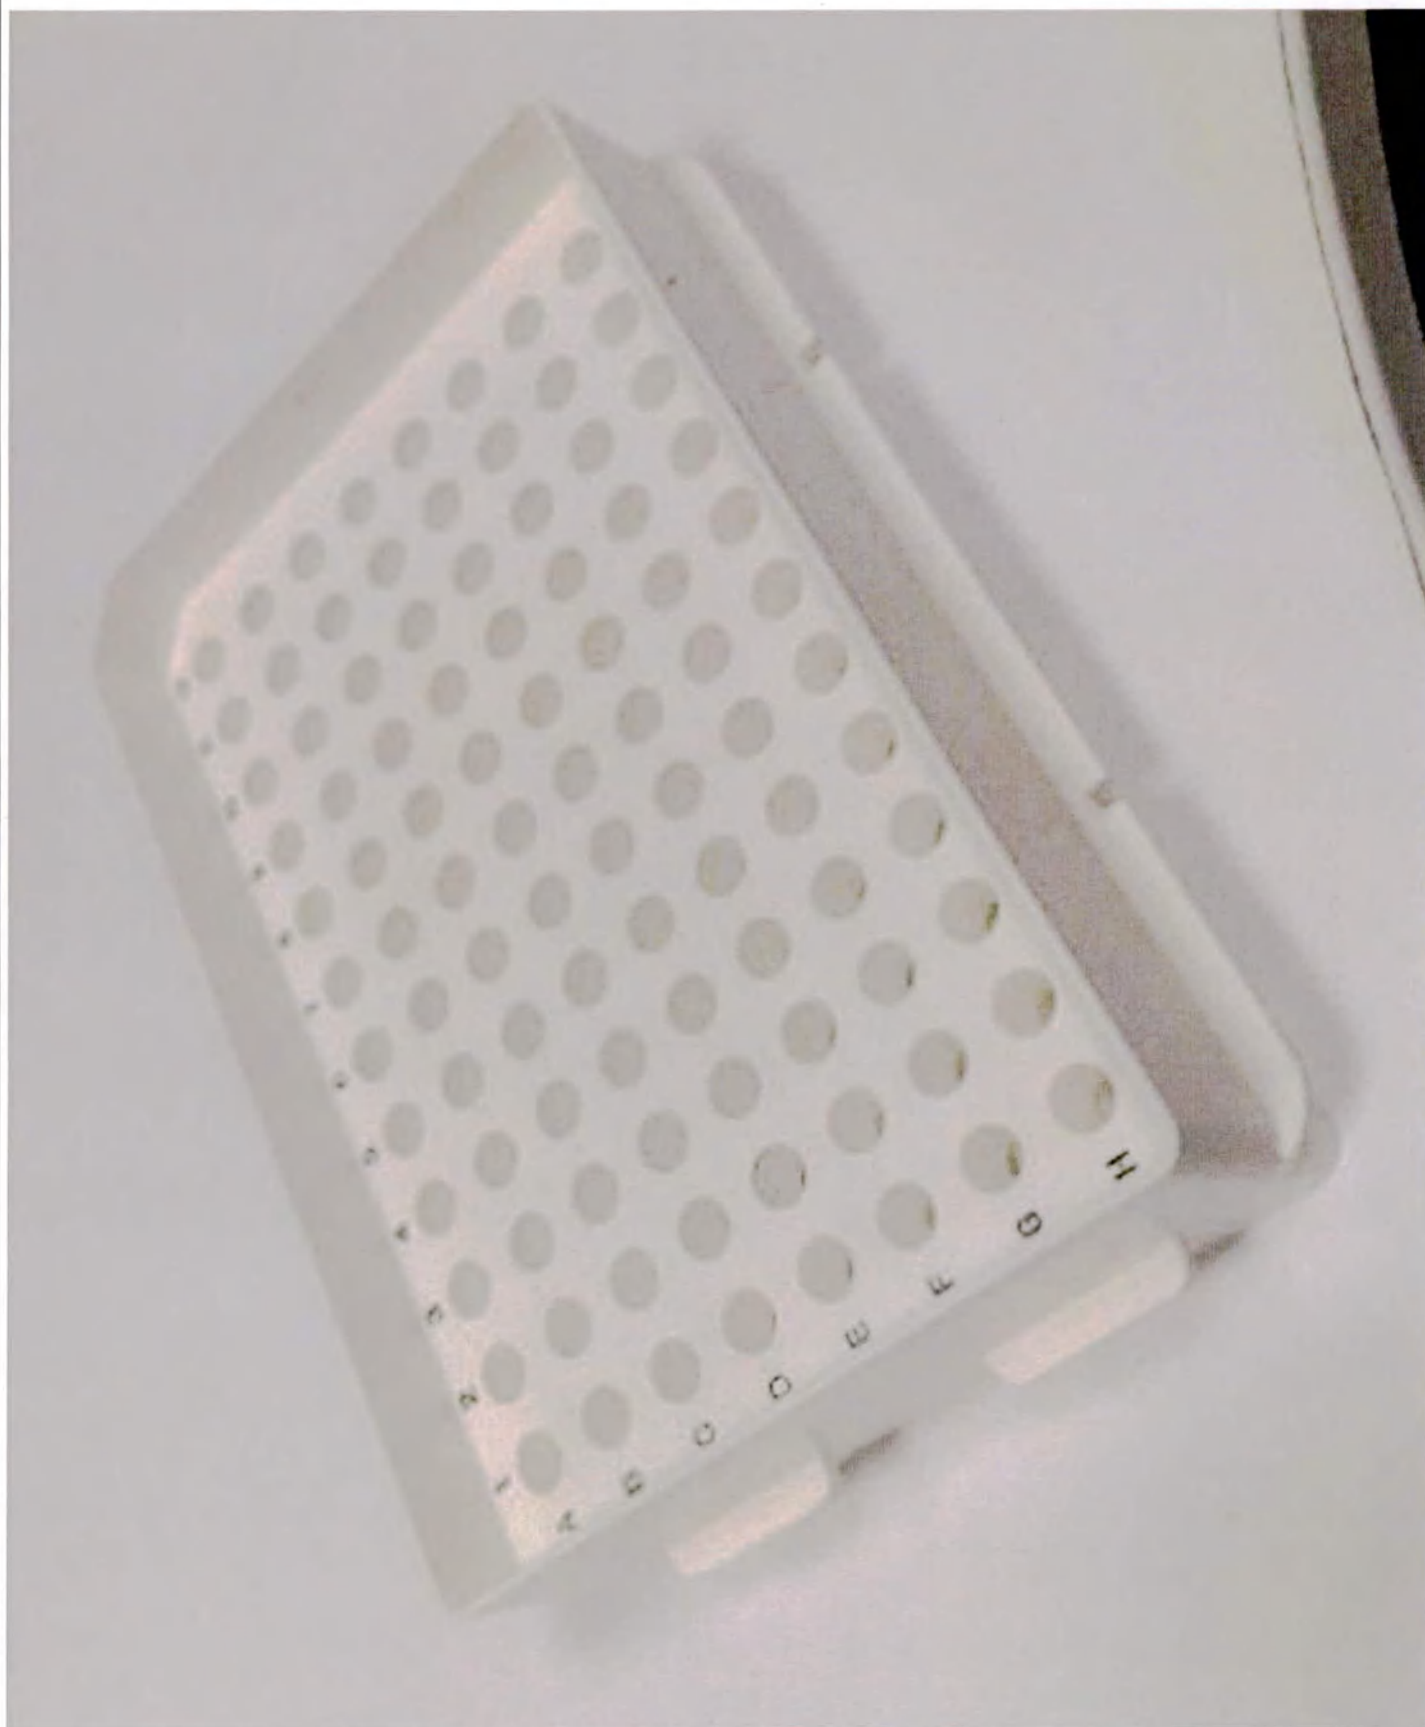


Держатель планшета 96-луночного (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Контейнер для воды (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

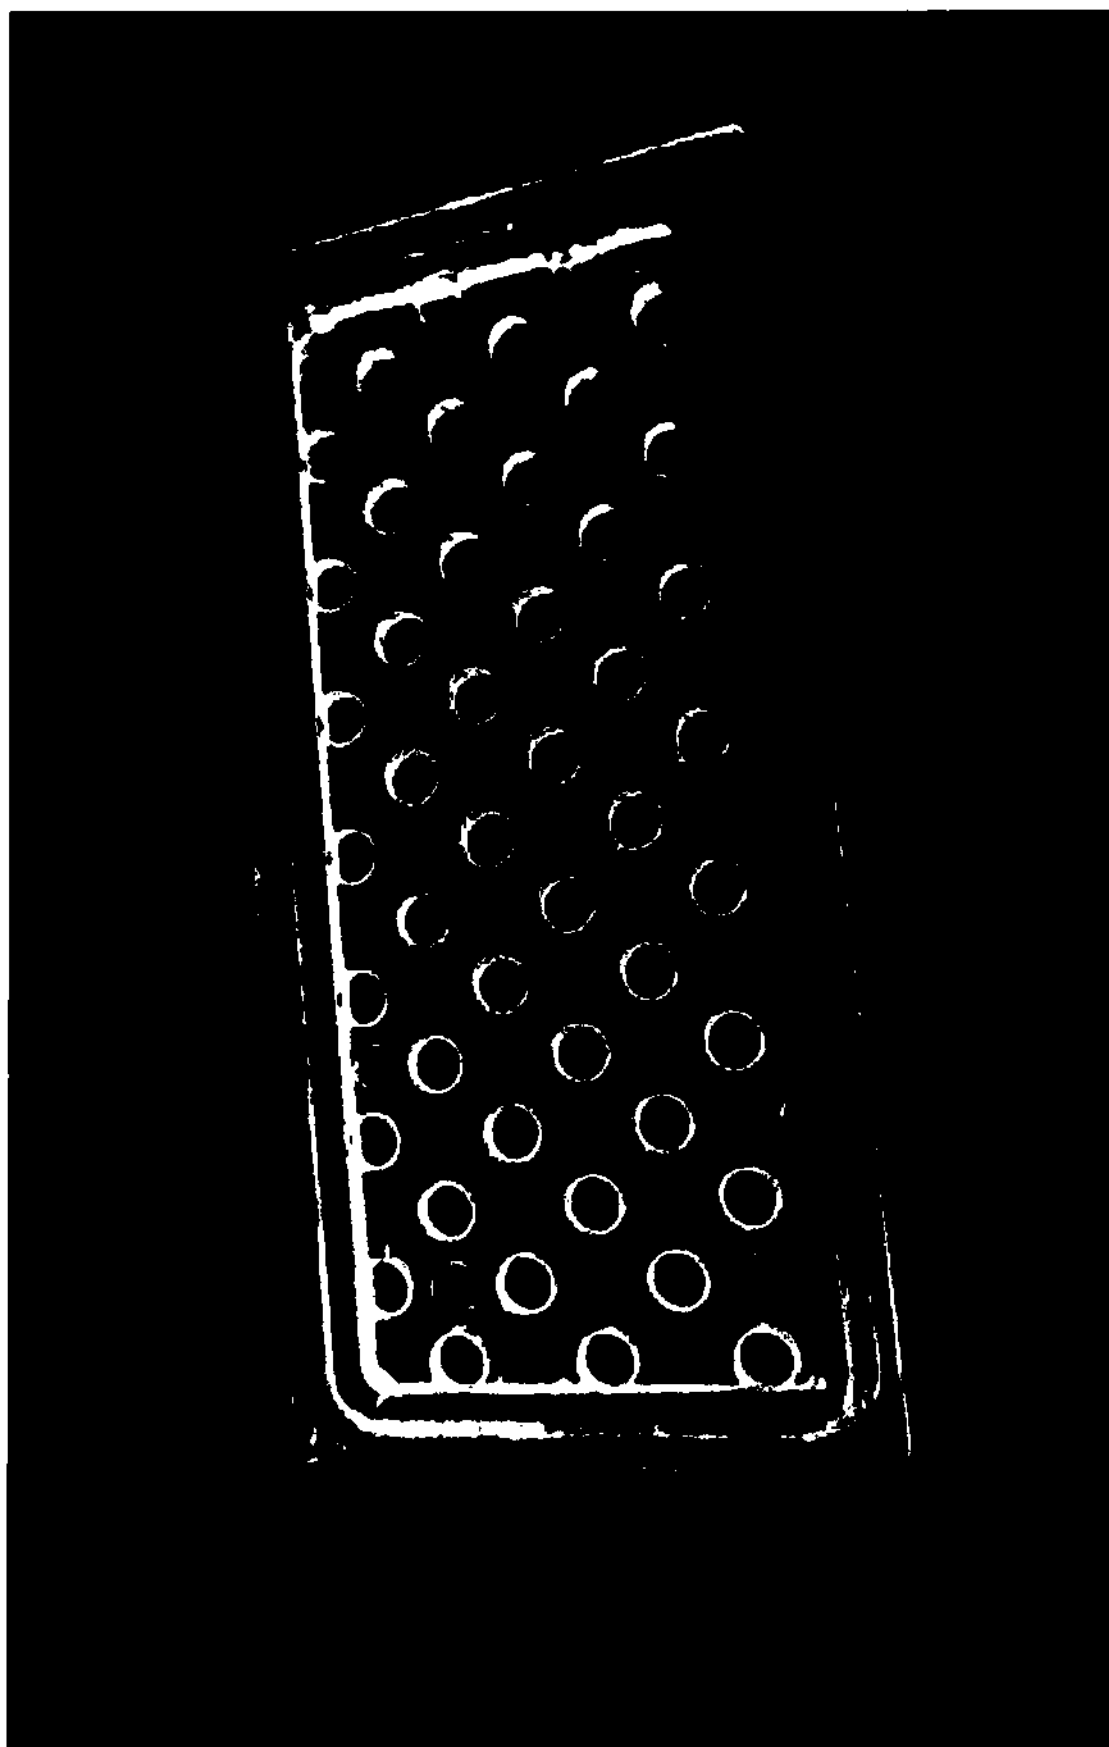


Крышка контейнера для воды (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)


Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

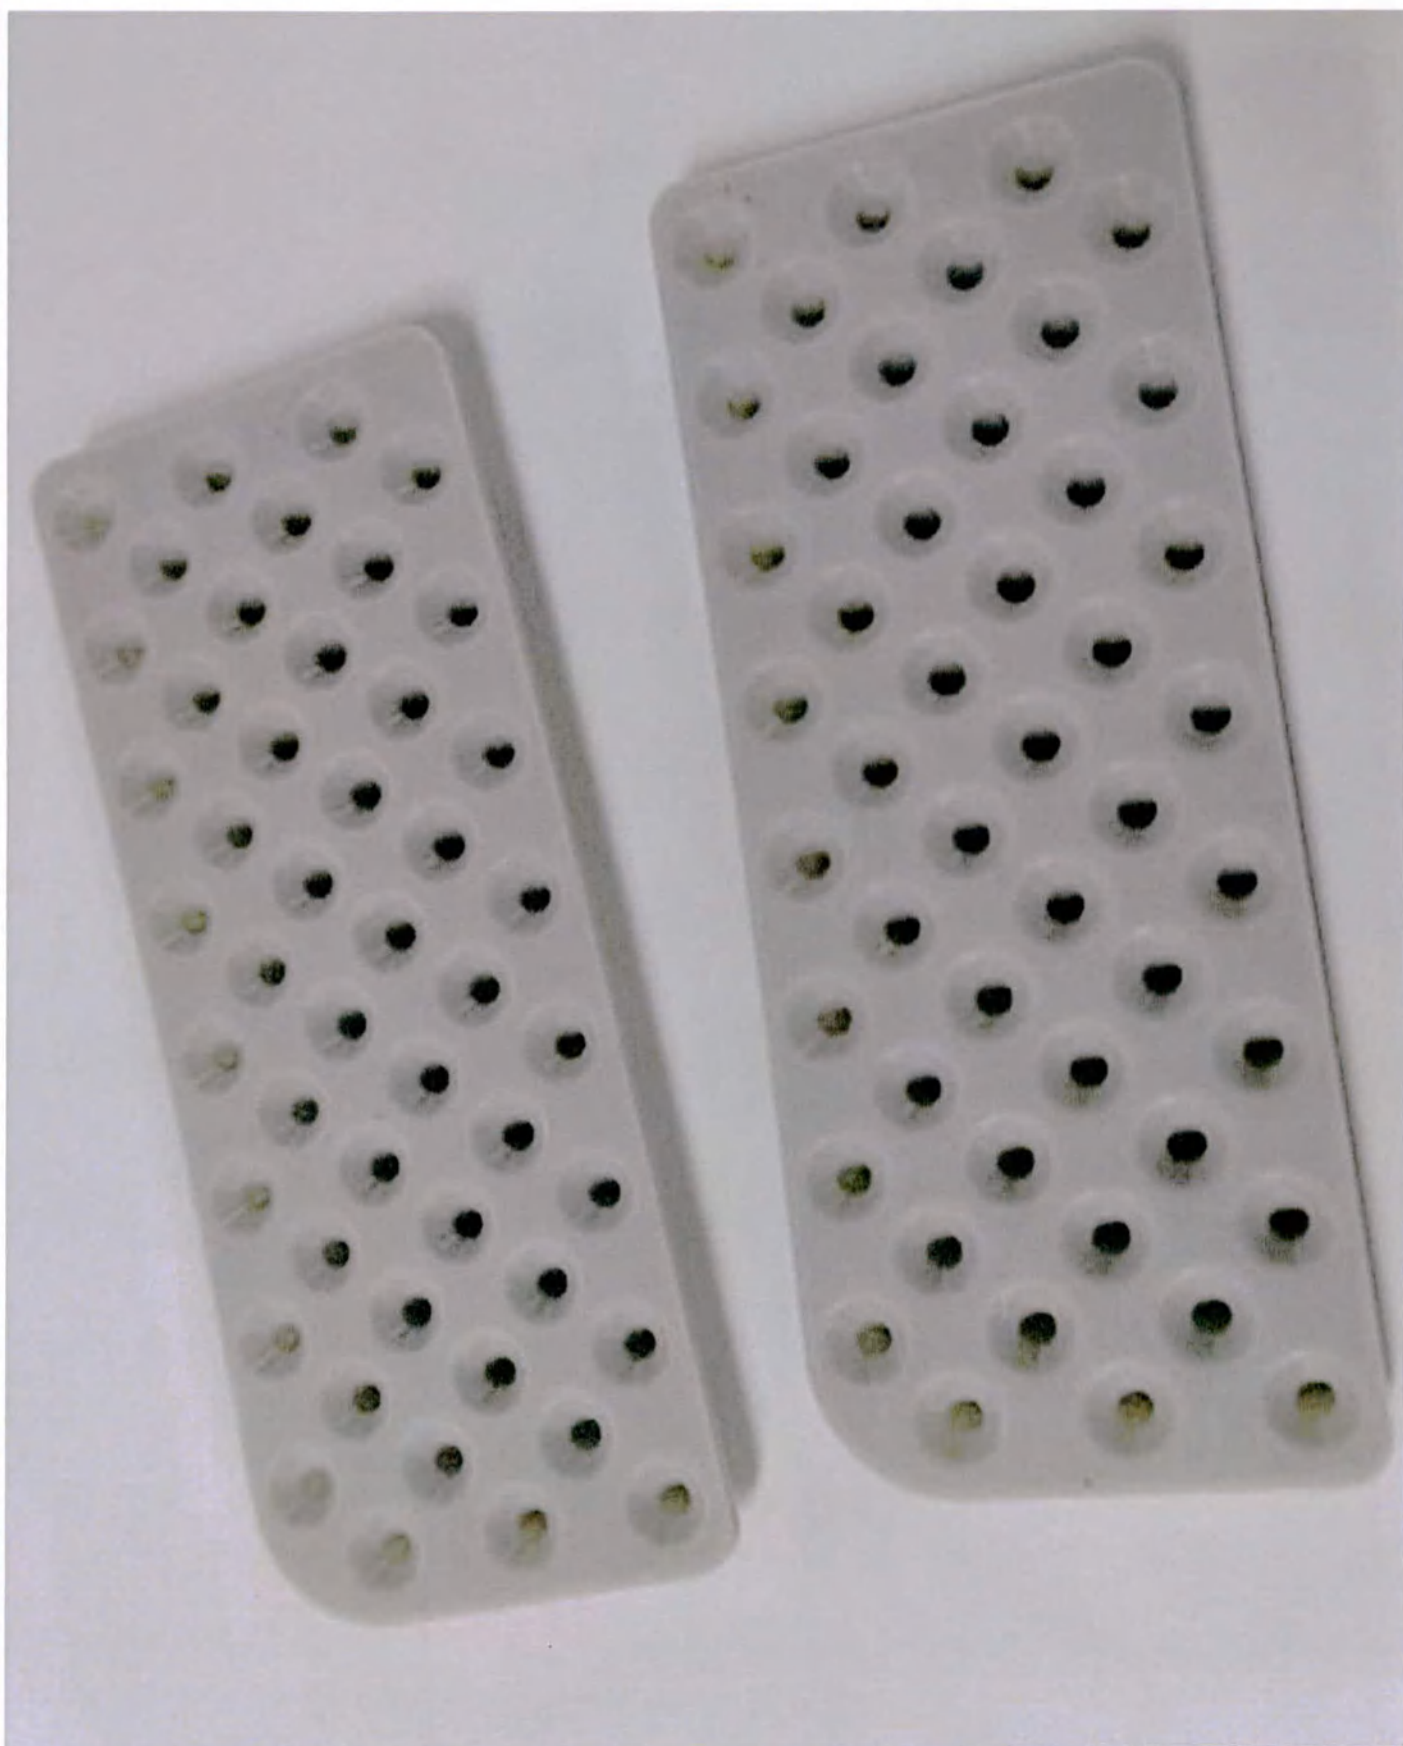

Антииспаритель (септа) контейнера для воды (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

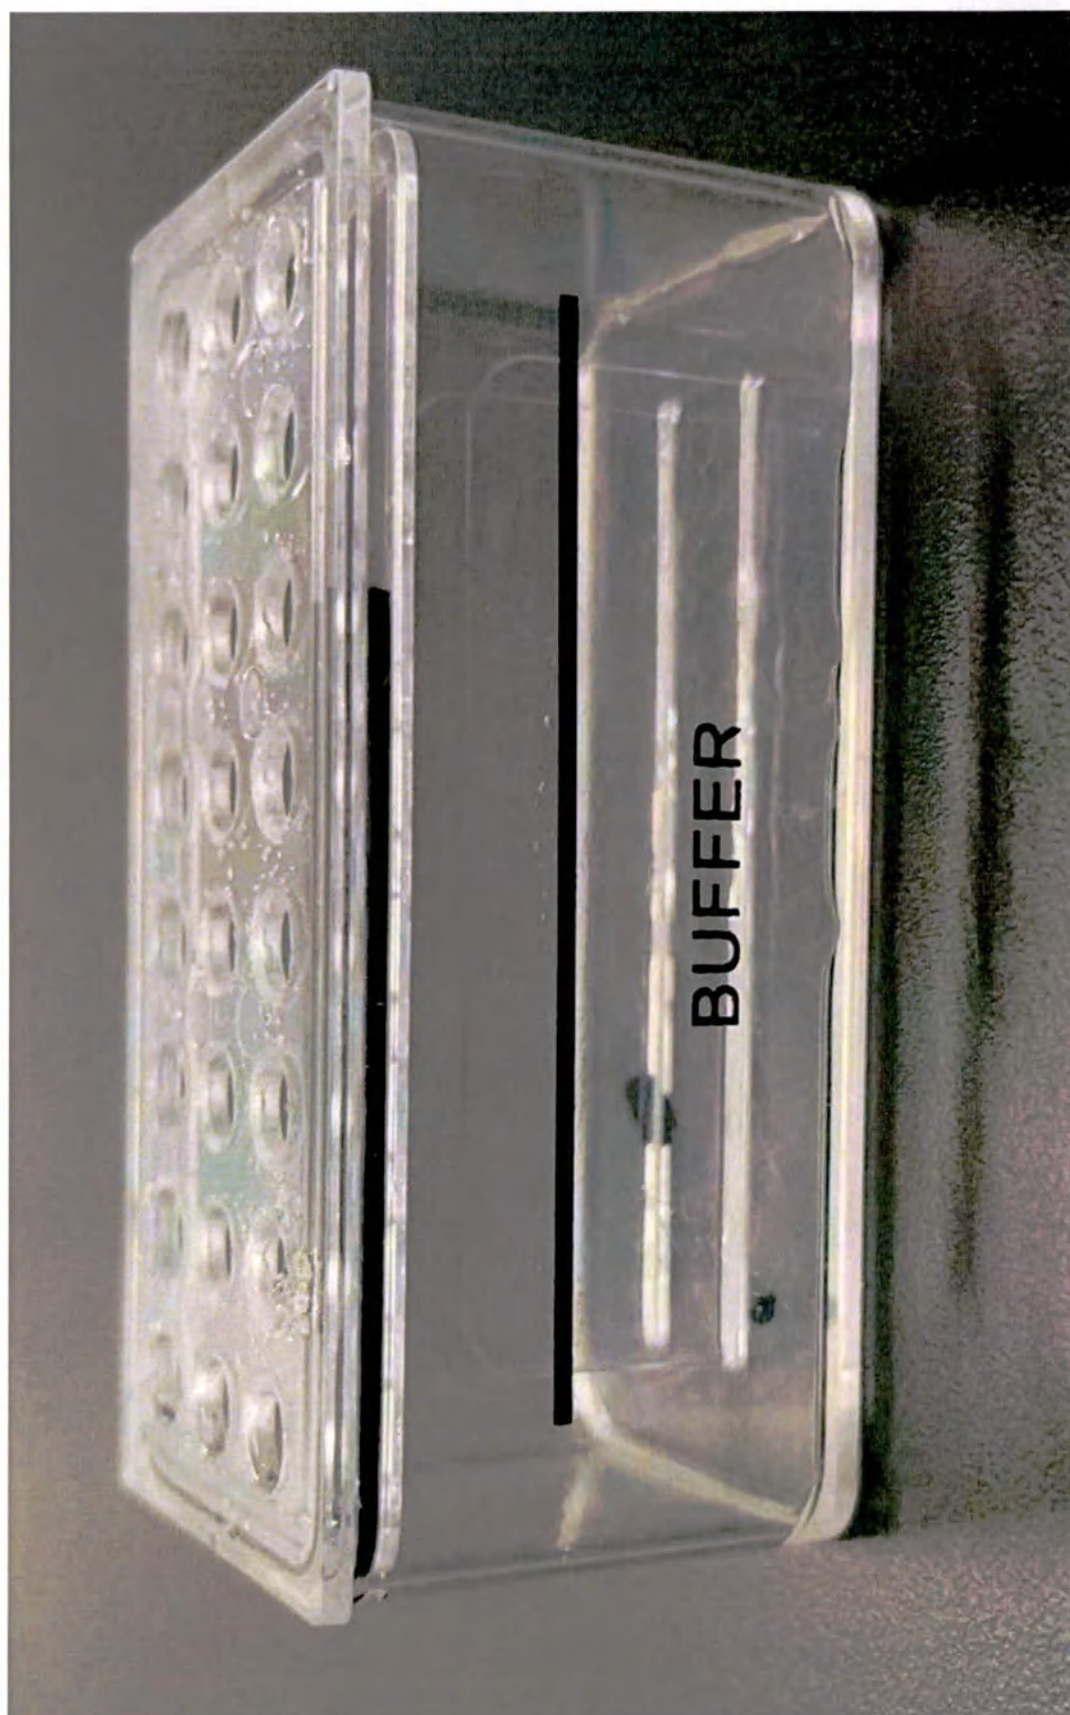


Контейнер для катодного буферного раствора (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

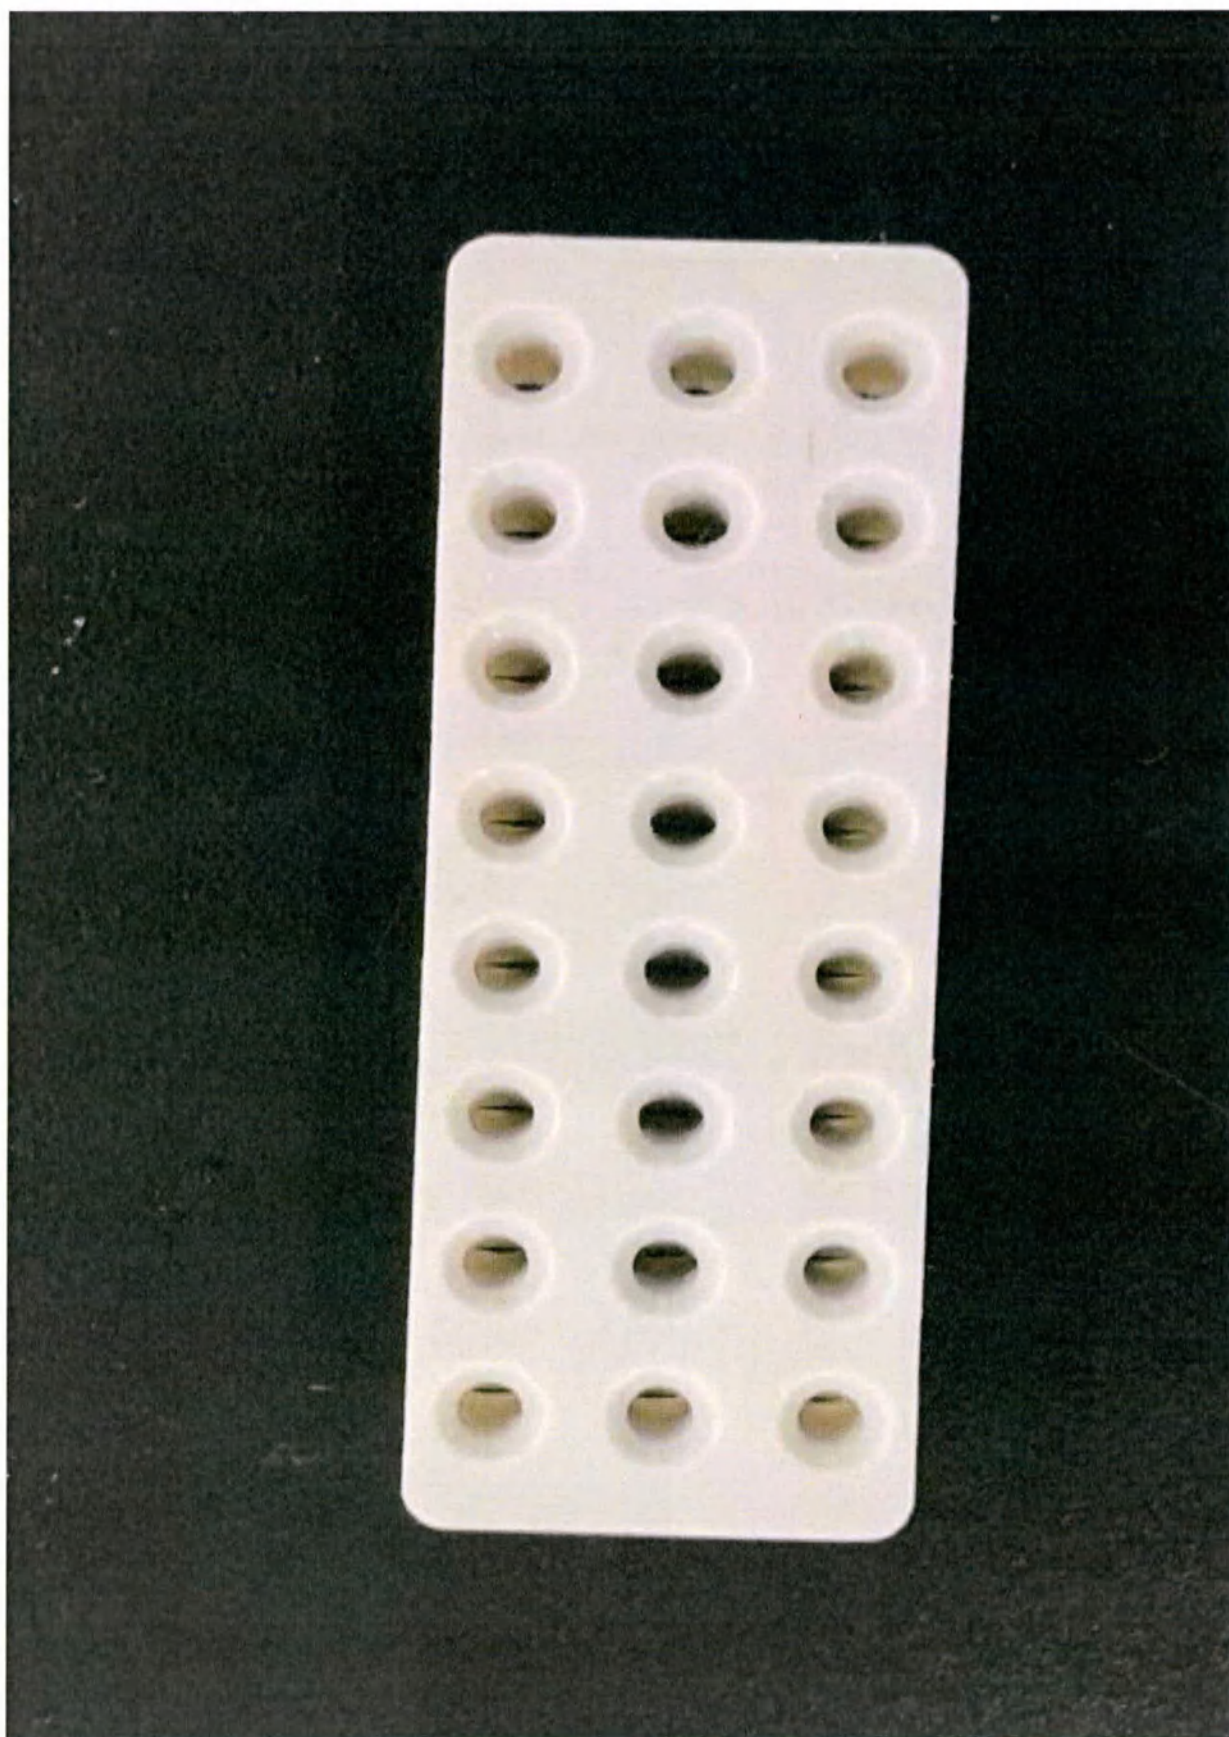

Антииспаритель (септа) контейнера буферного раствора (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Контейнер для воды (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

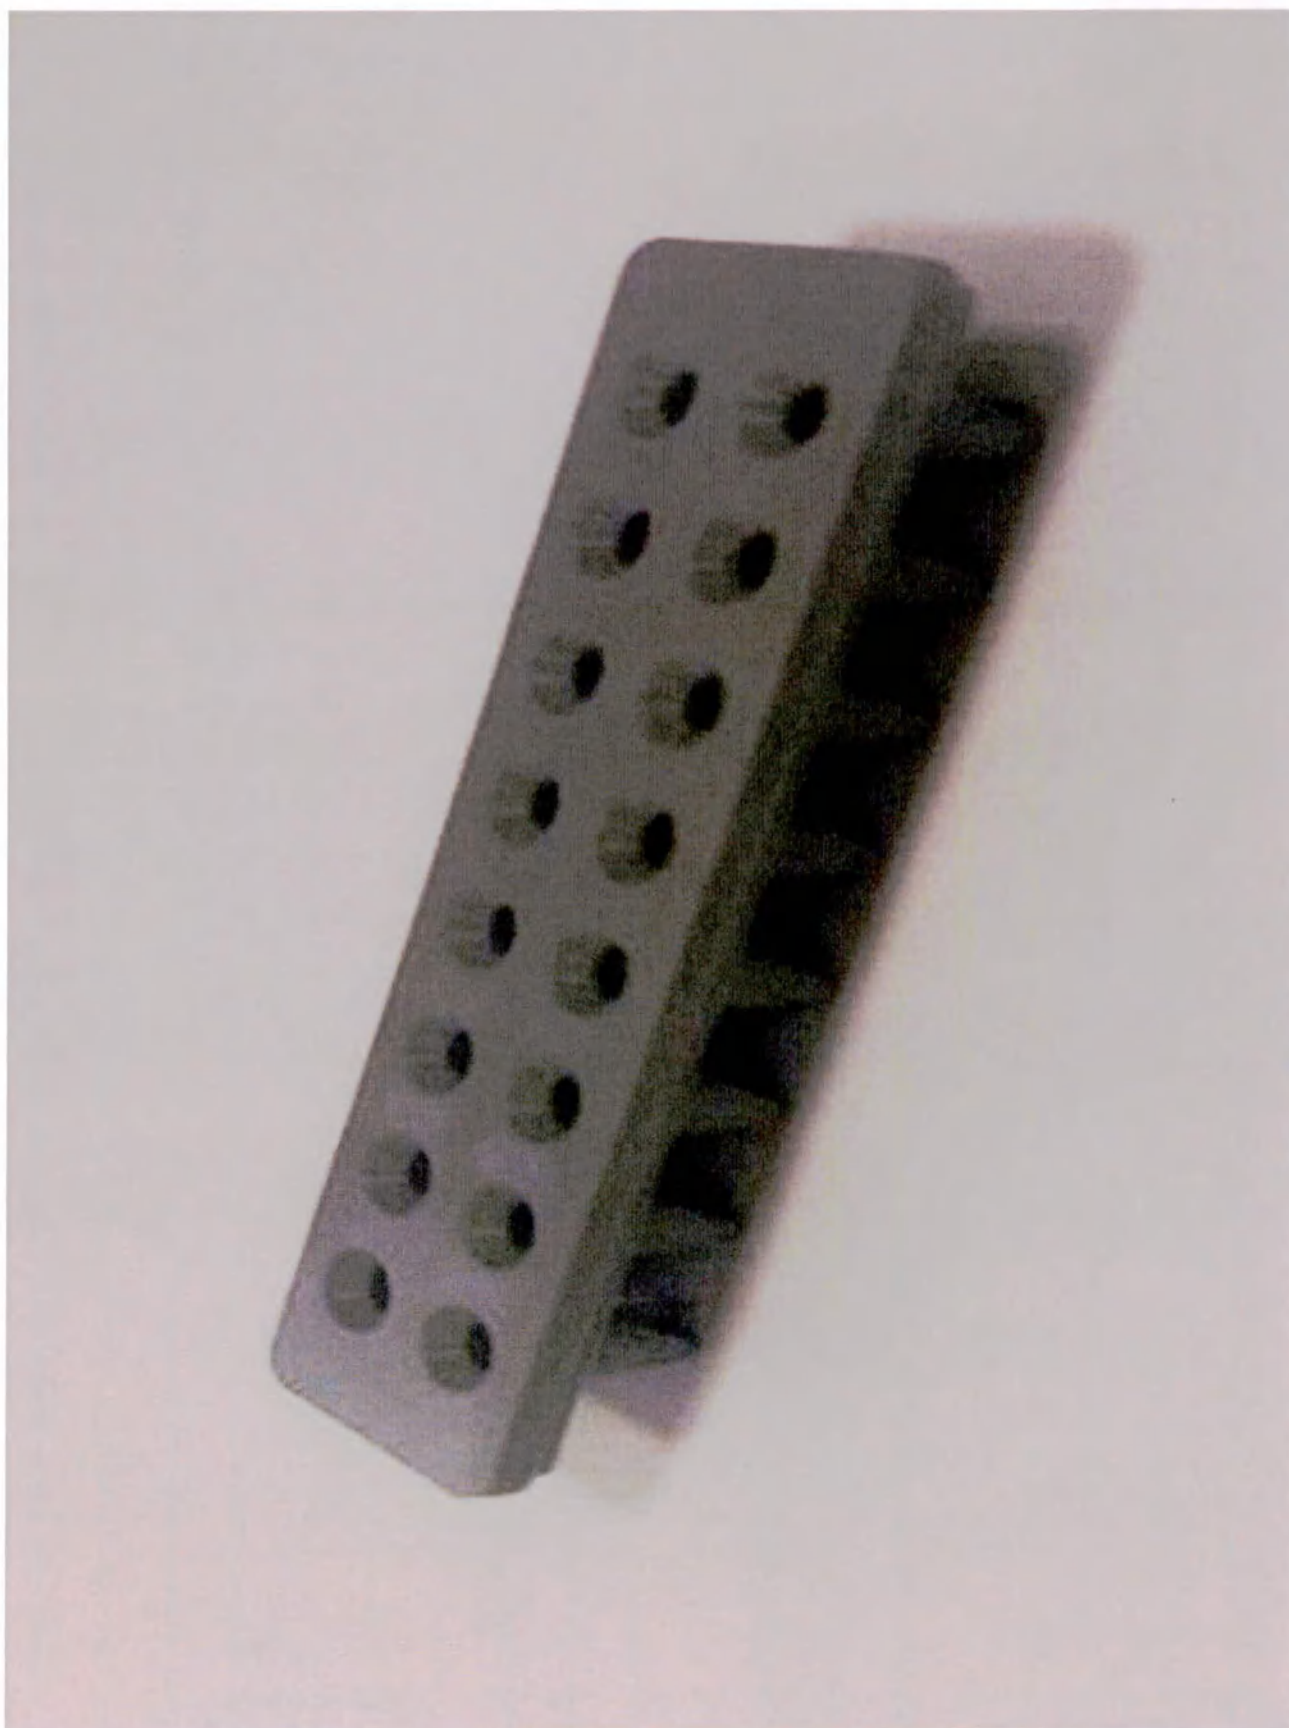

Антииспаритель (септа) контейнера для воды (Генетический анализатор (секвенатор) G16)



Контейнер для катодного буферного раствора (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

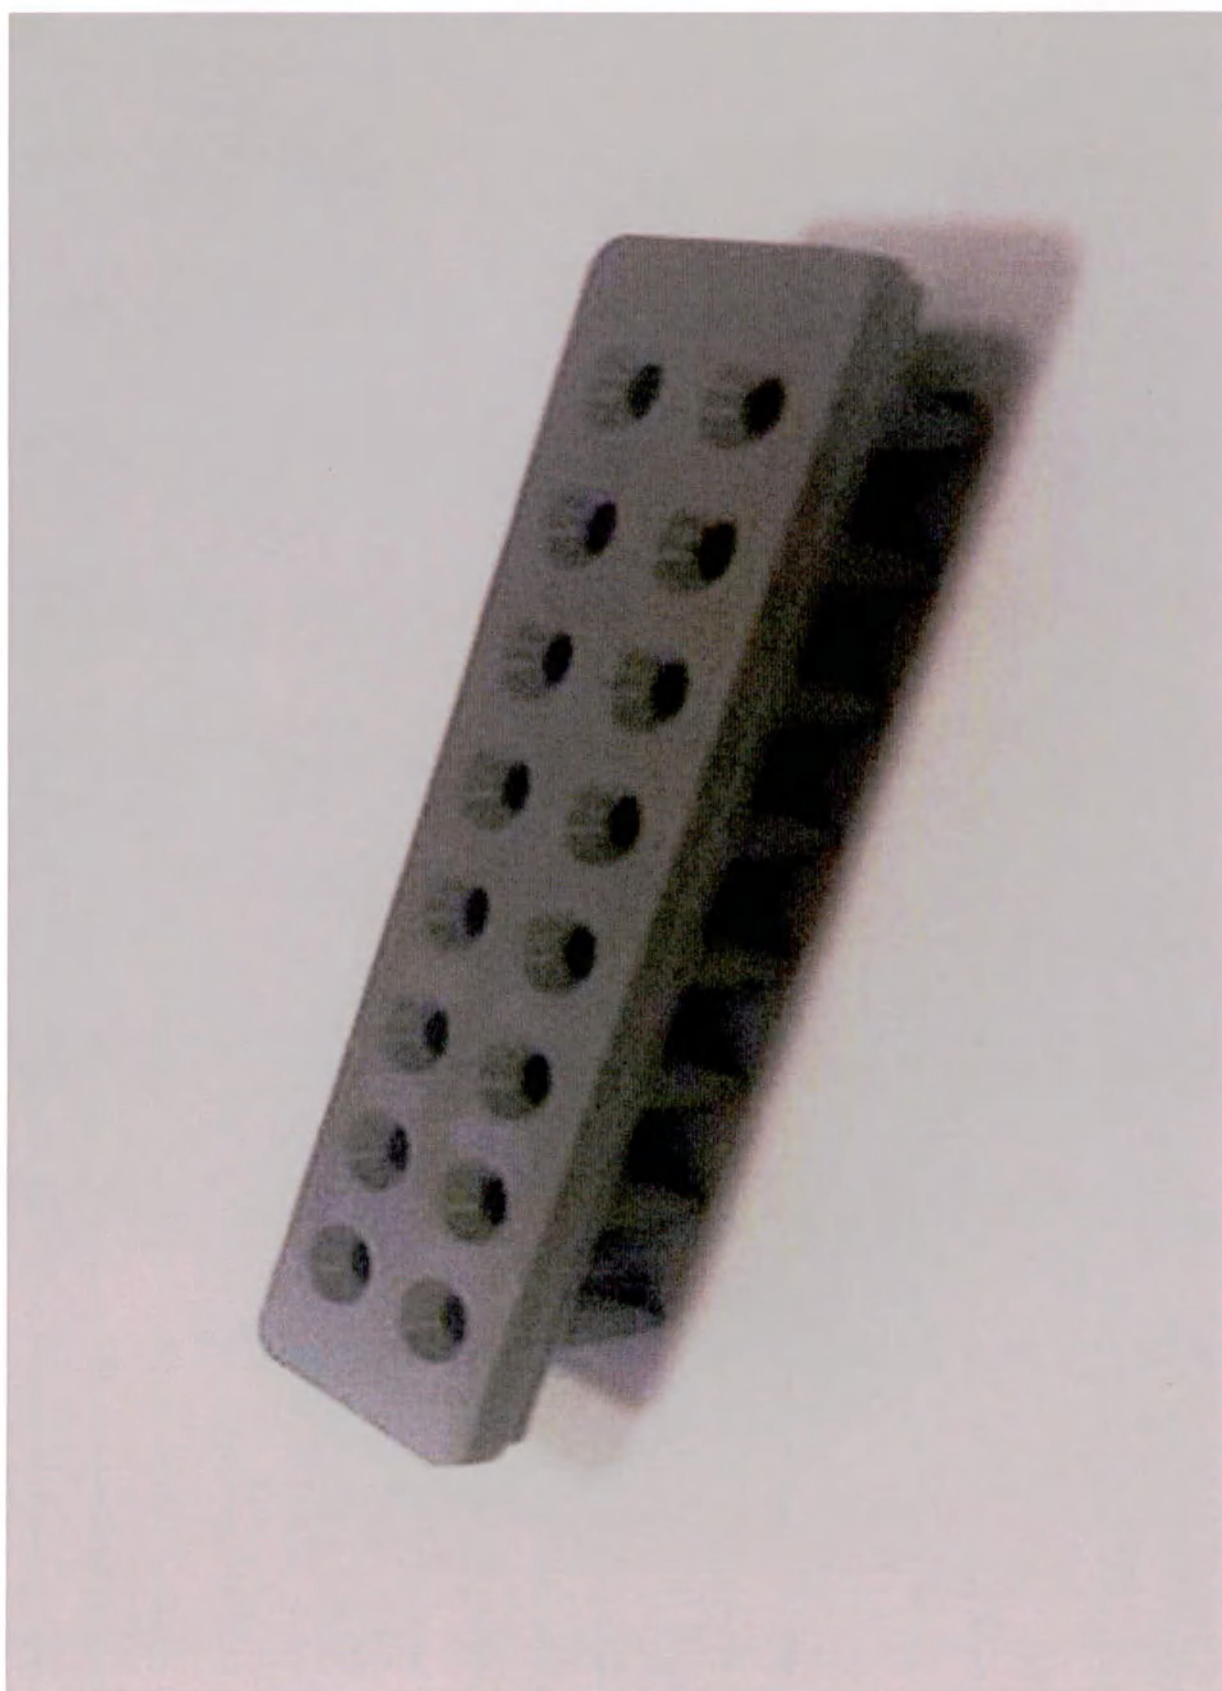


Антииспаритель (септа) контейнера буферного раствора (Генетический анализатор (секвенатор) G16)




Контейнер для анодного буферного раствора (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

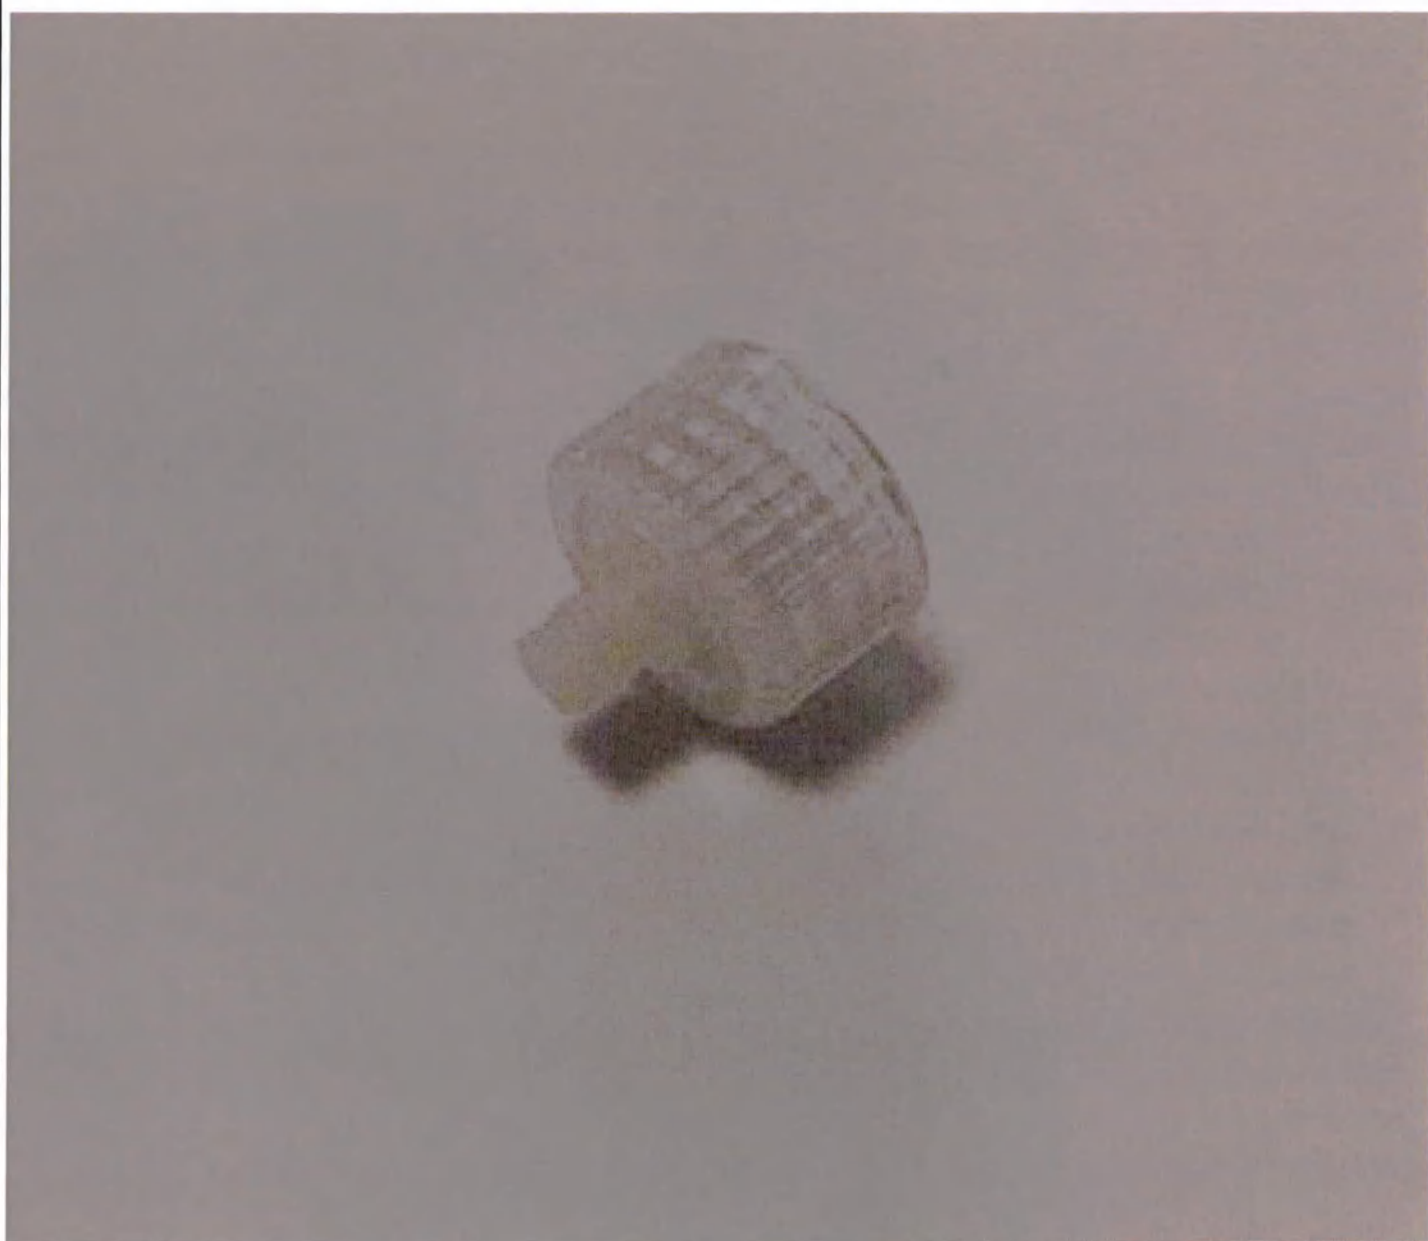

Колпачок от пыли для упаковки с полимером (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

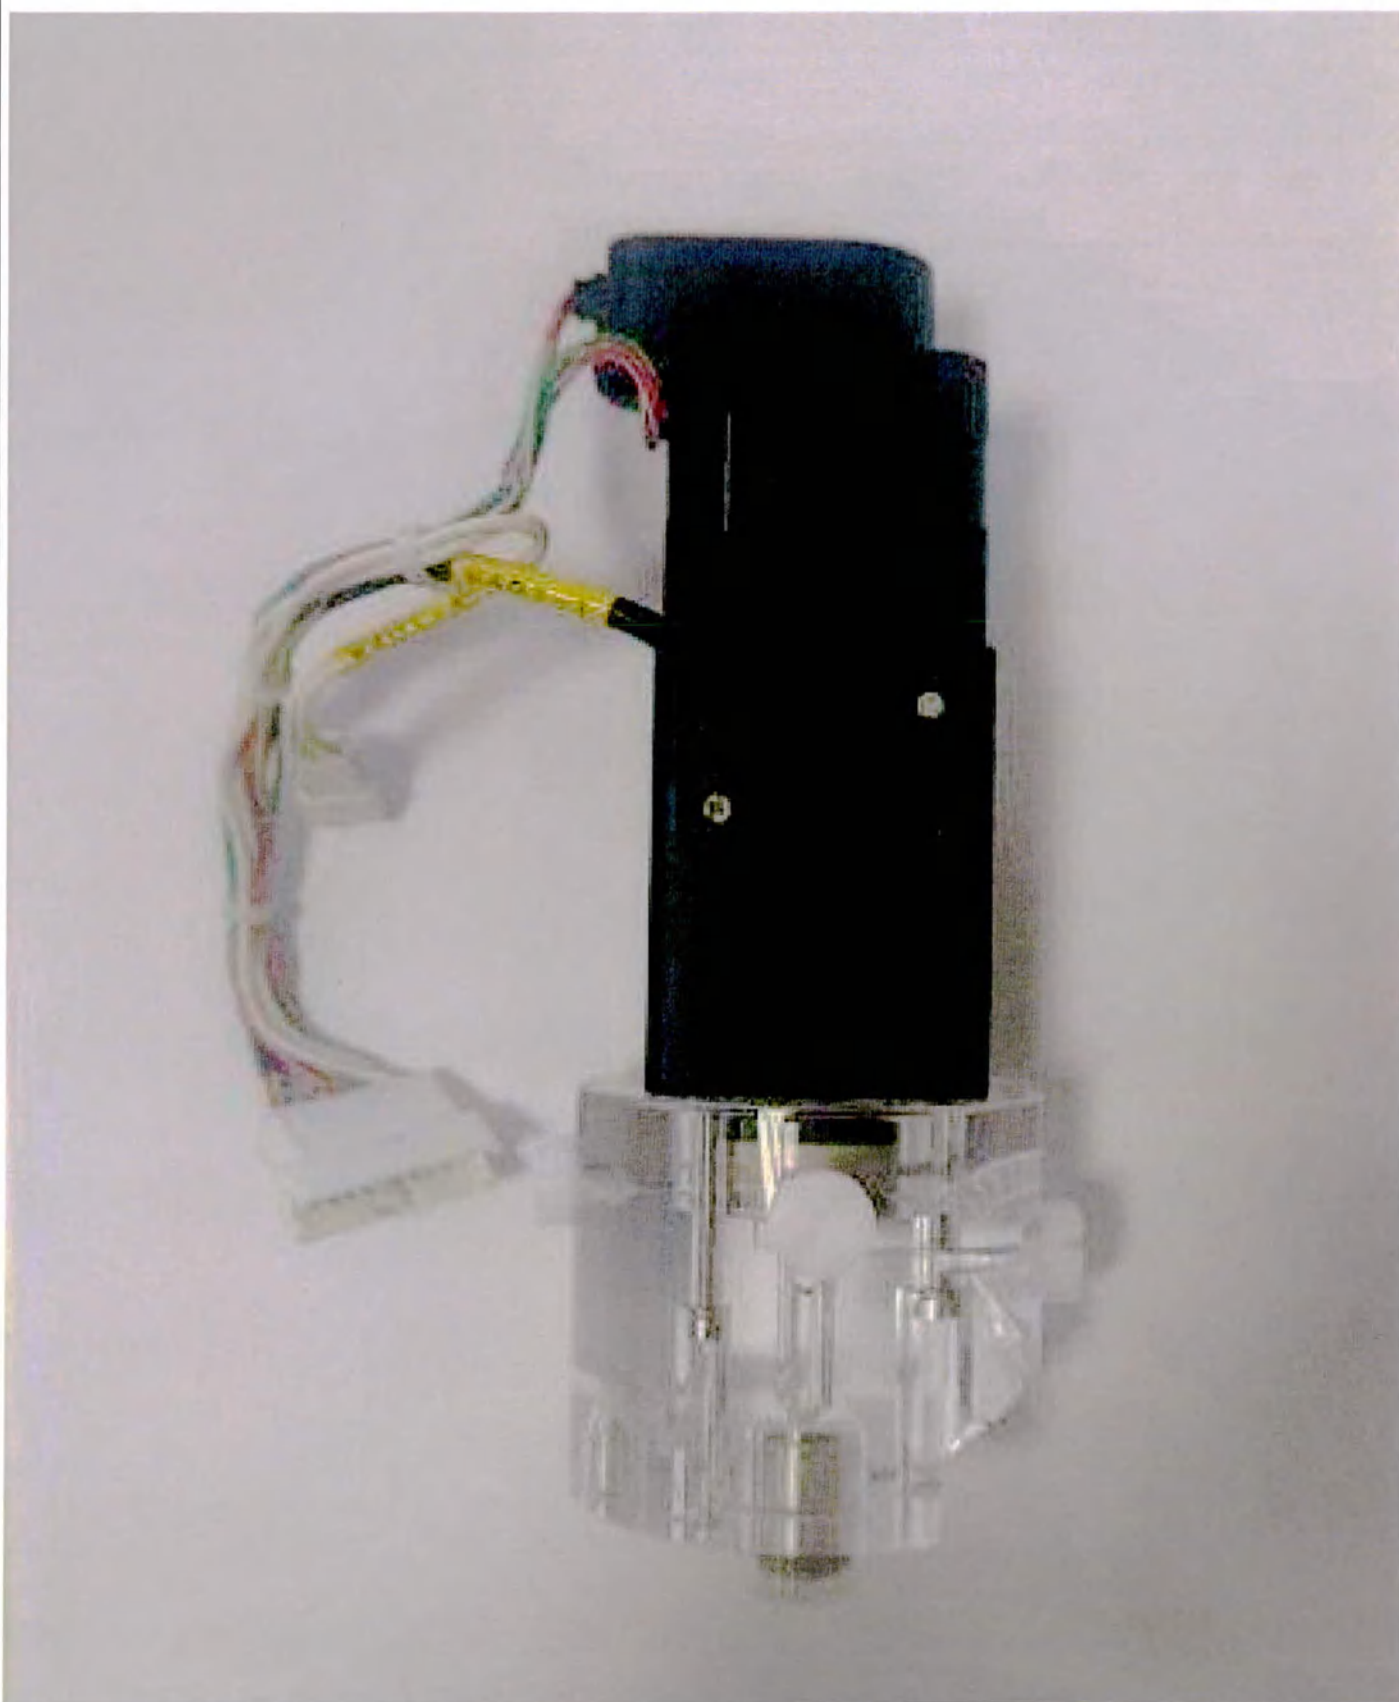


Верхний блок (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Винт фиксации наконечника линейки капилляров со стороны оптического окна (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Винт фиксации наконечника линейки капилляров со стороны оптического окна (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

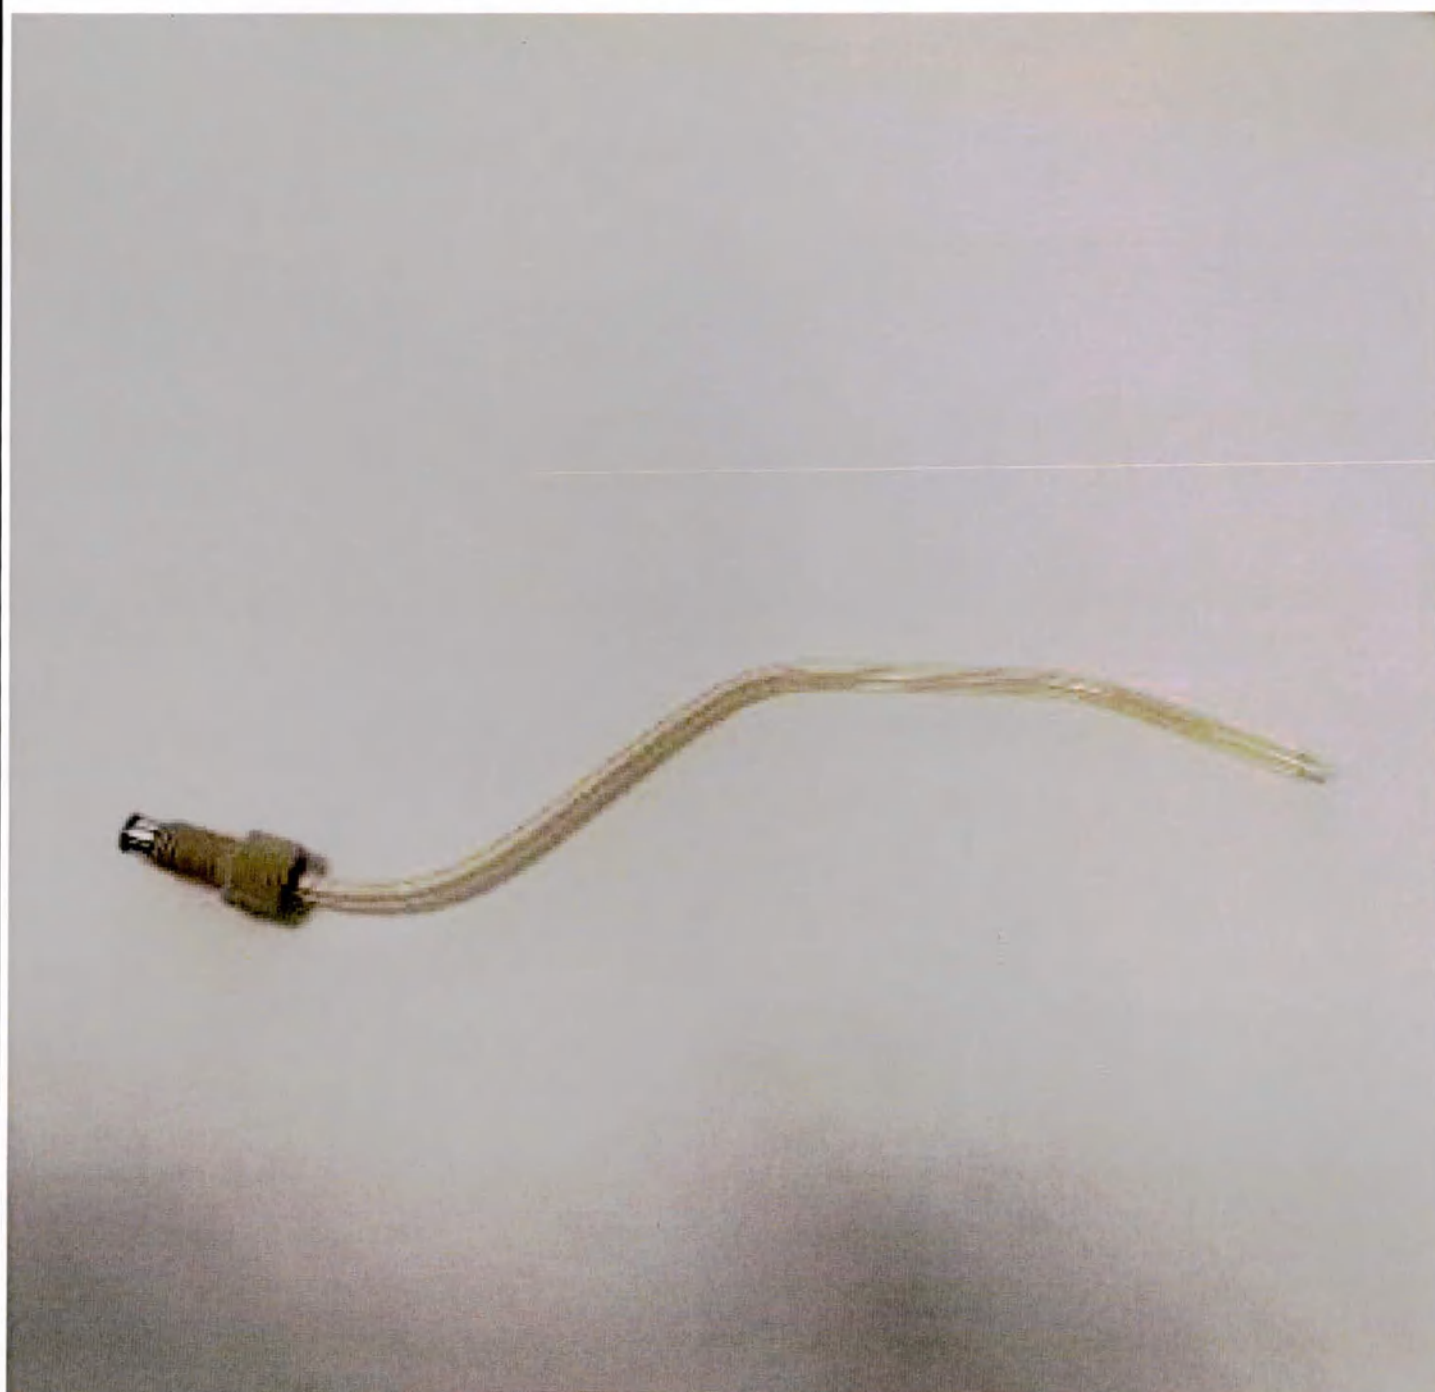


Трубка ввода полимера (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

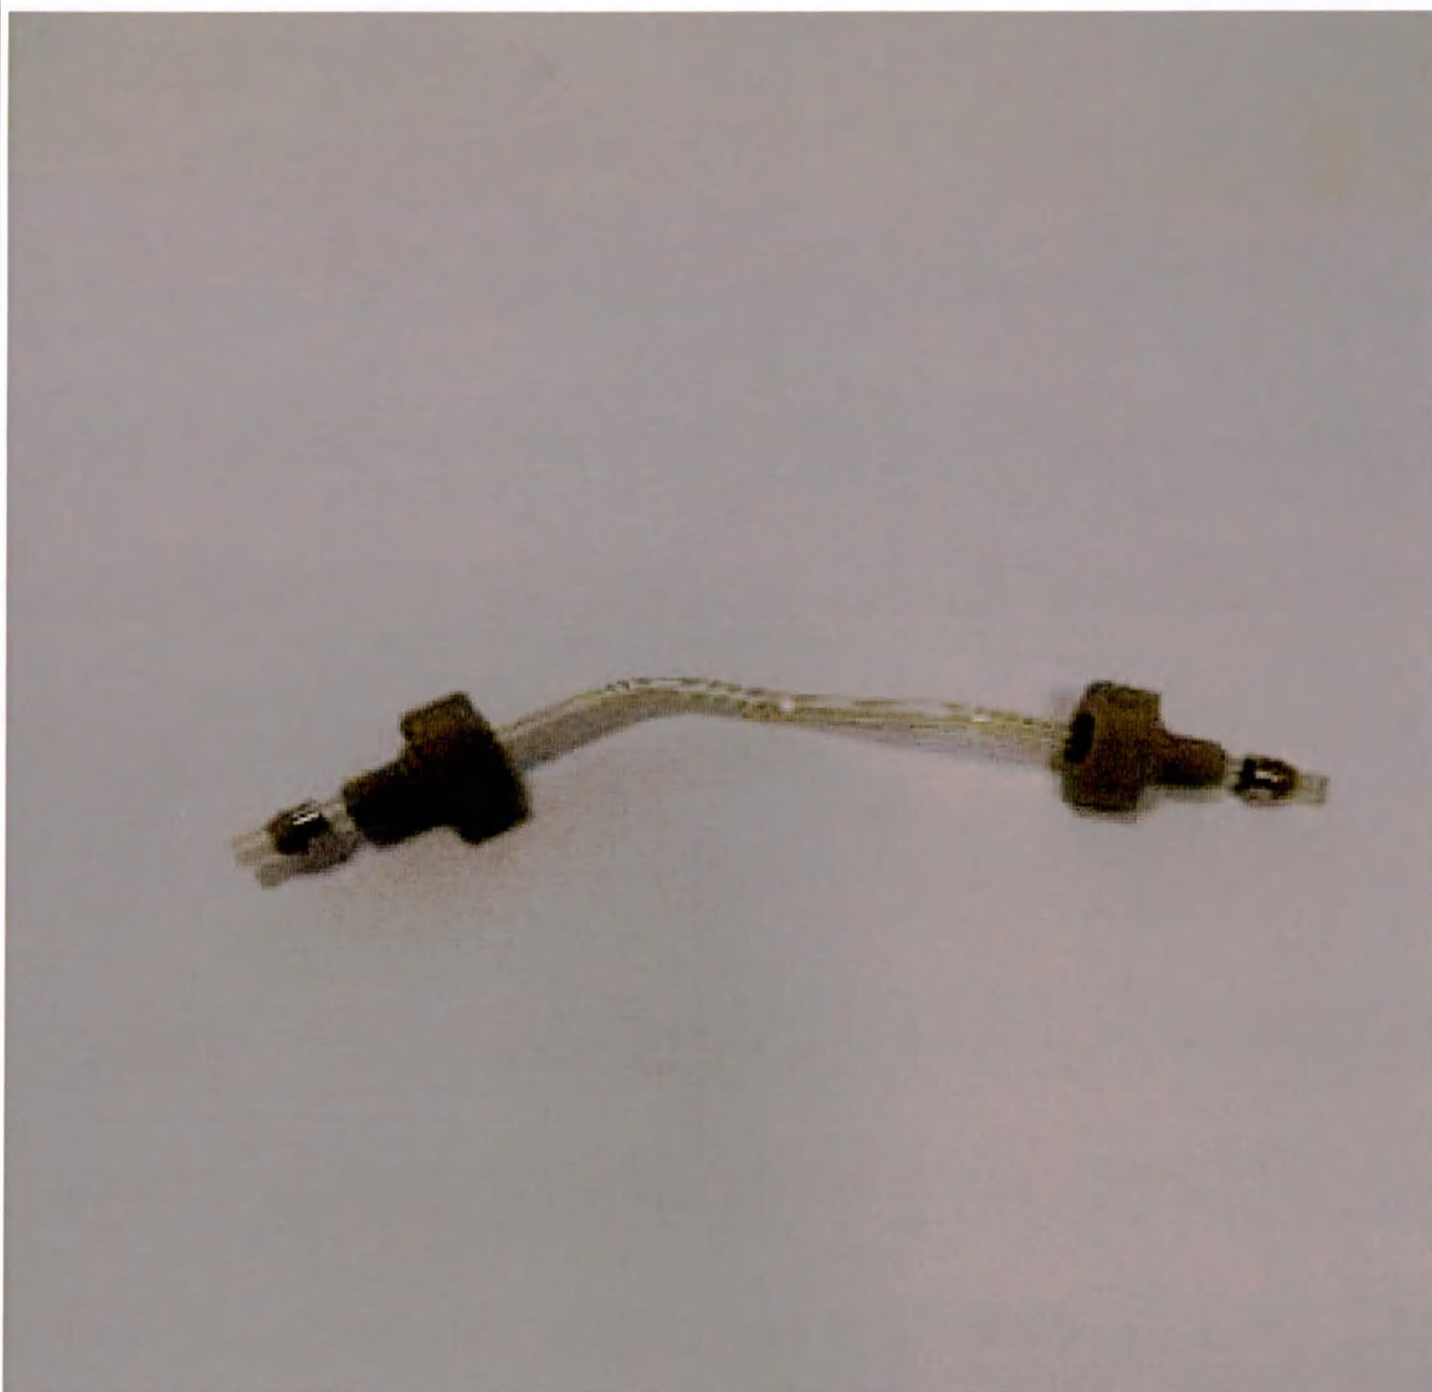

Трубка нижнего блока (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

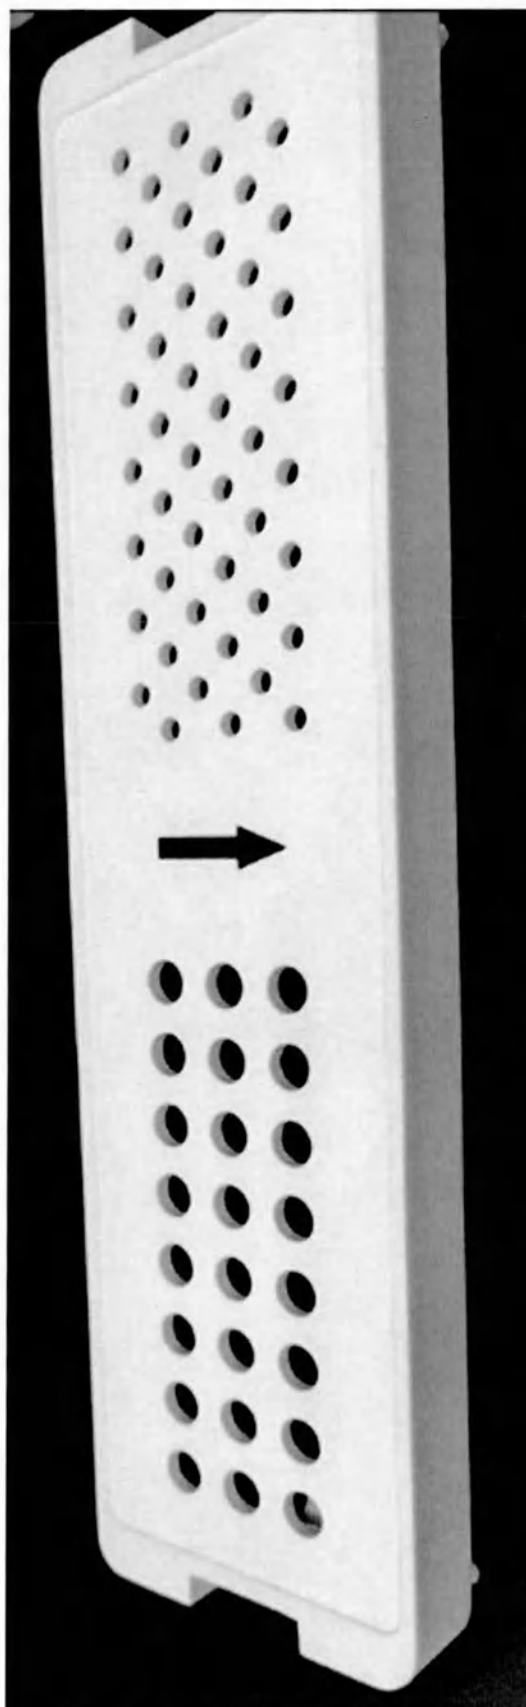


Защитная накладка позиционера (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

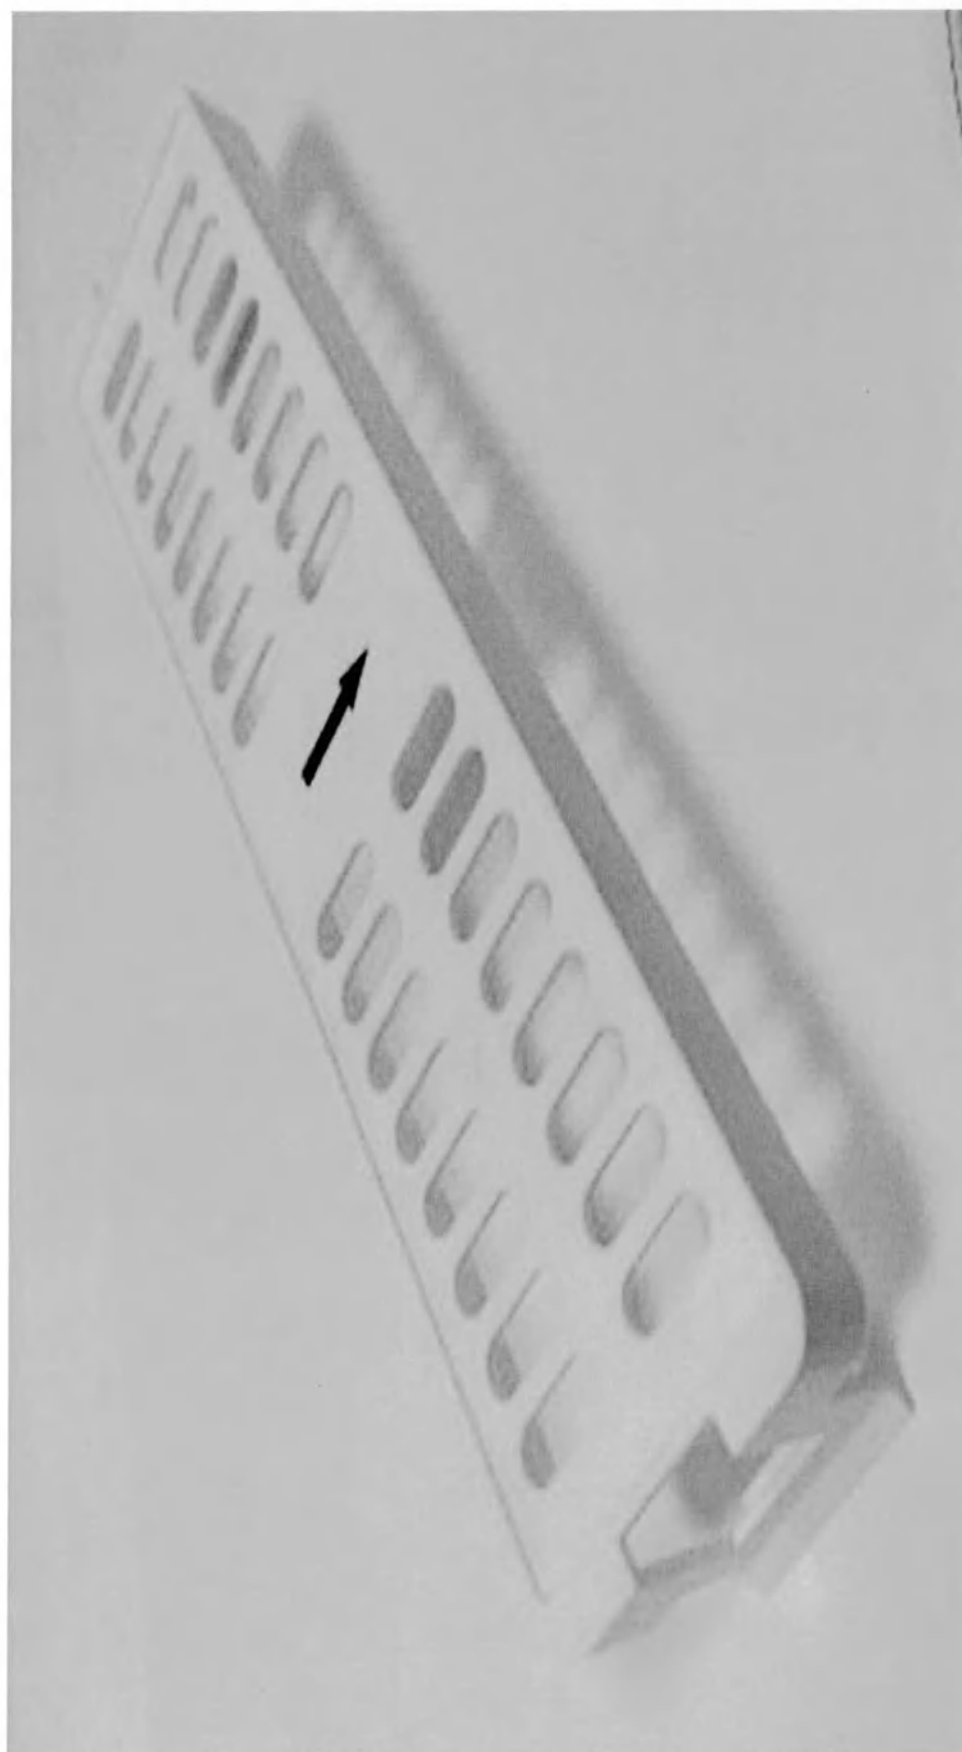

Защитная накладка позиционера (Генетический анализатор (секвенатор) G16)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

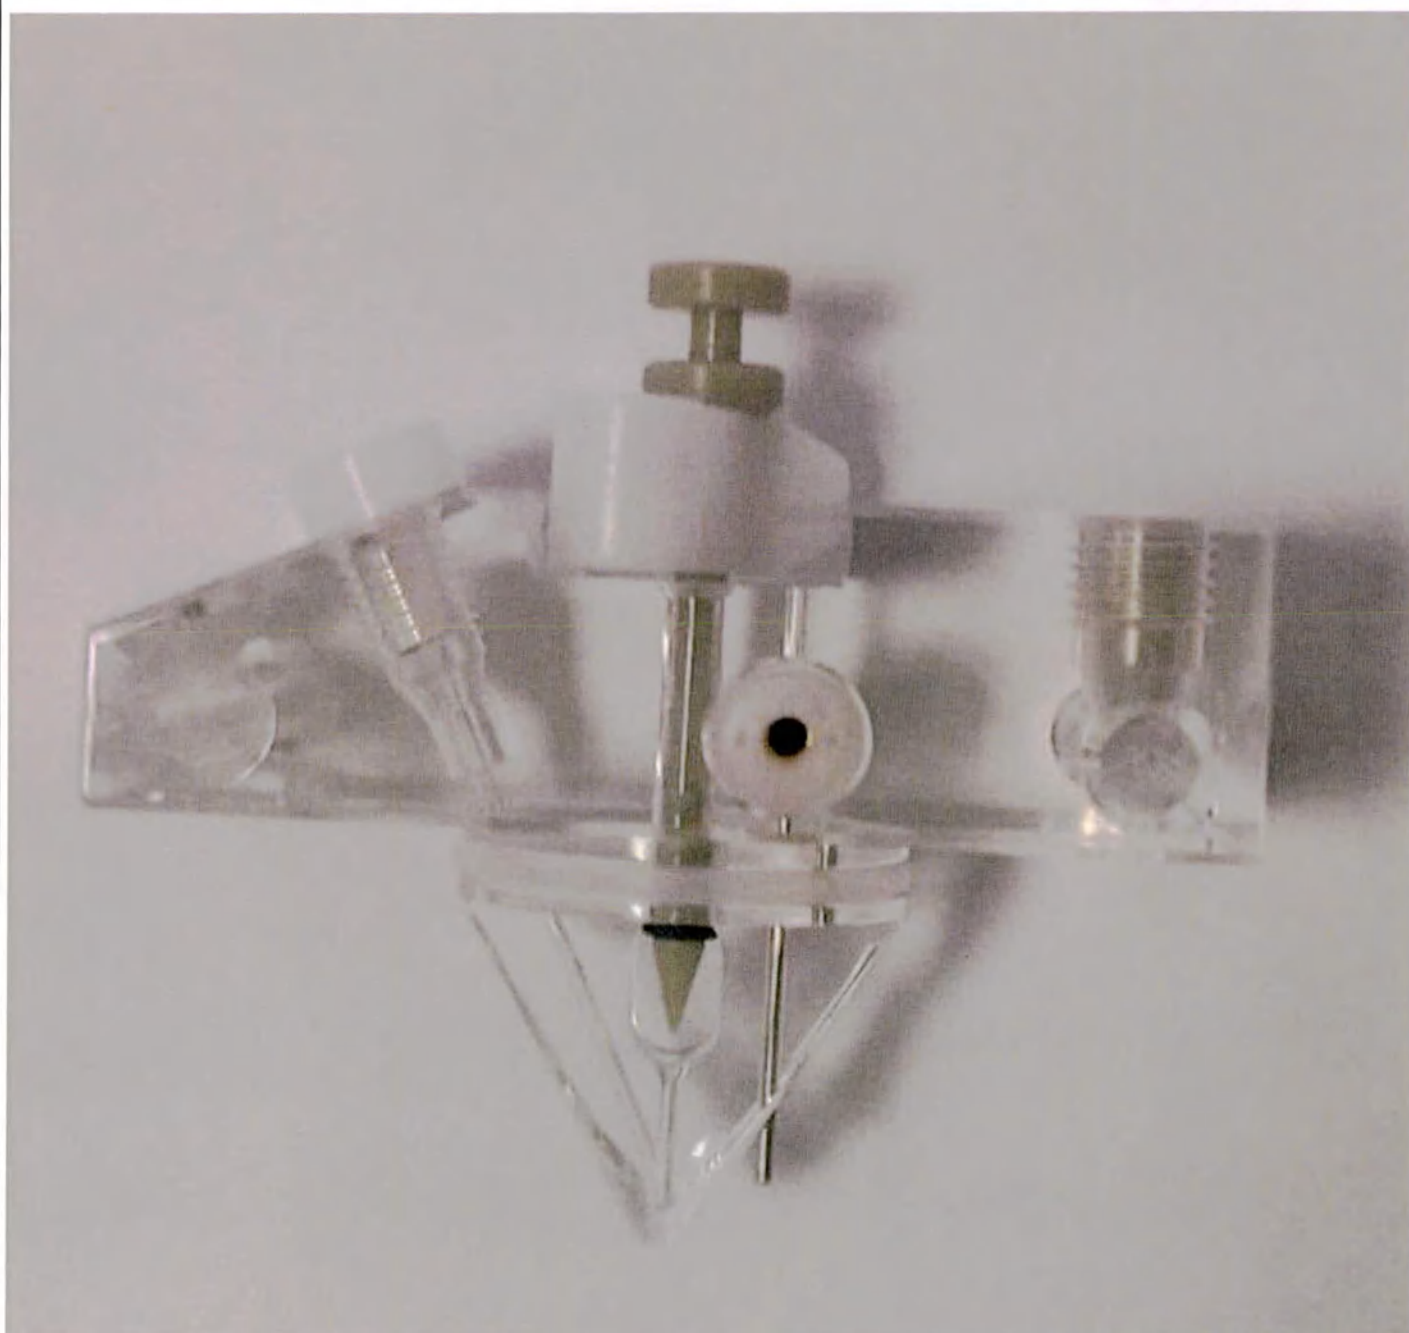

Нижний блок (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**



Входной выходной штуцер верхнего блока (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)



Пластиковый шприц (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Компьютер (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Кабель сетевой для компьютера (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Программное обеспечение Genetic Analyzer Data Collection Software на компакт-диске (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**

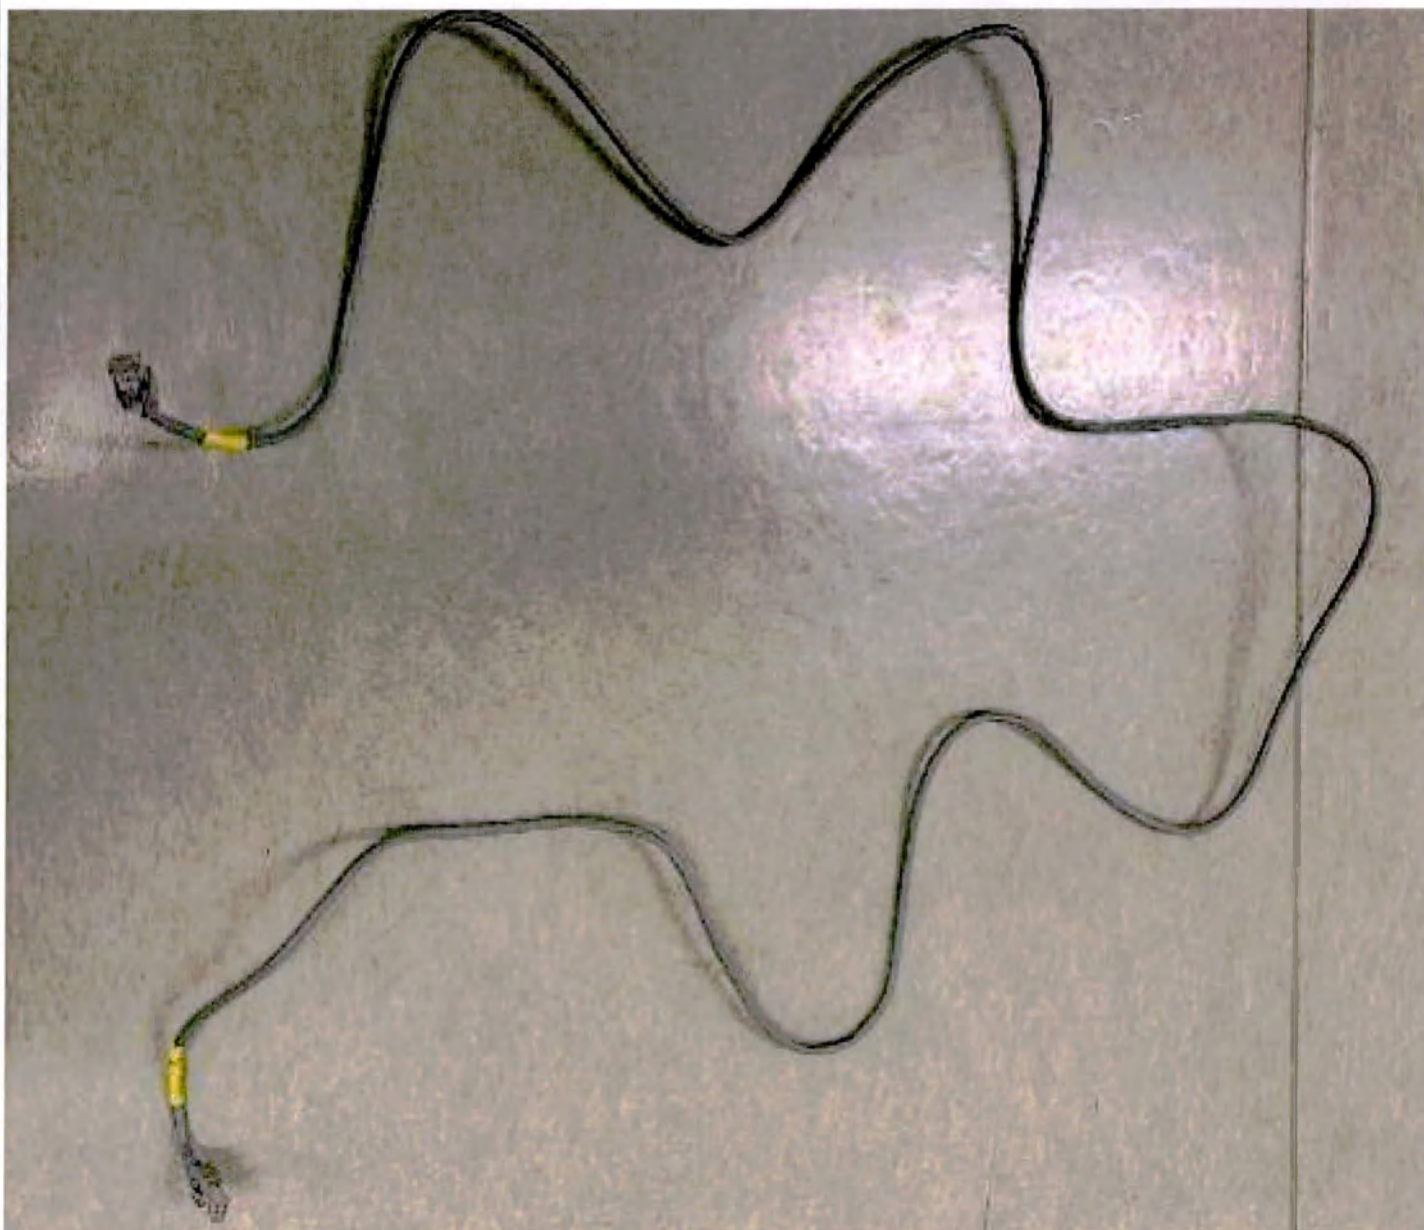

Интернет-кабель (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Переходник питания для генетического анализатора (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)



Переходник питания для компьютера (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

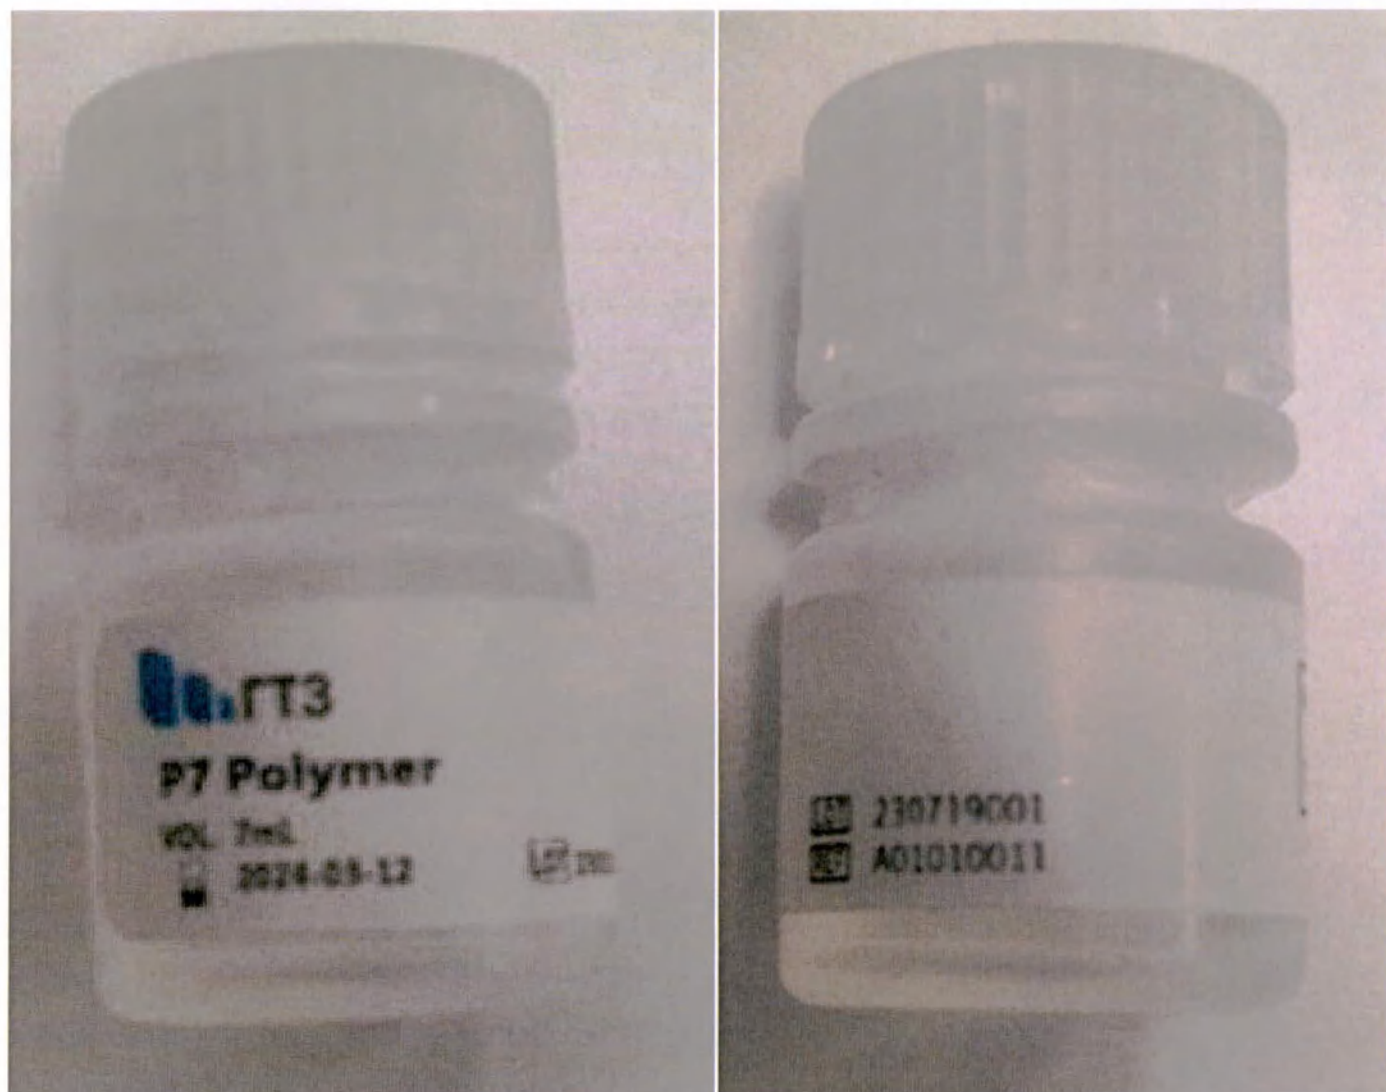


Полимер P7 7 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)



Полимер Р7 7 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

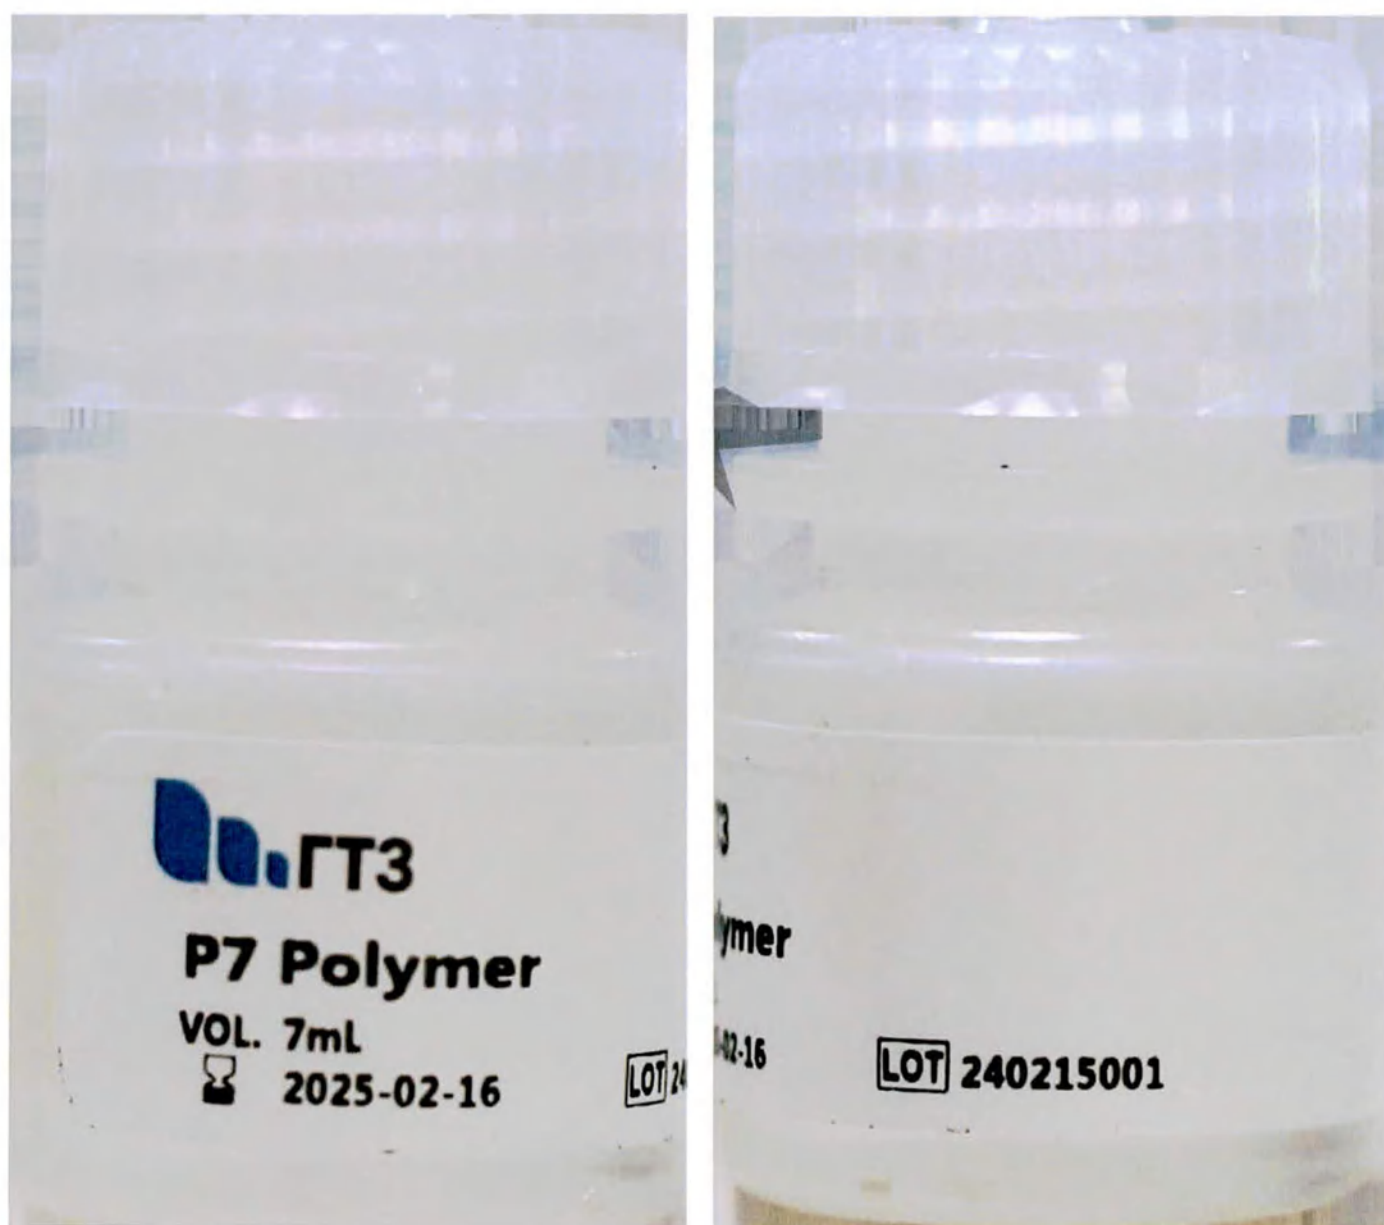

Полимер Р4 7 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)




Полимер Р4 7 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Формамид высокой чистоты 25 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

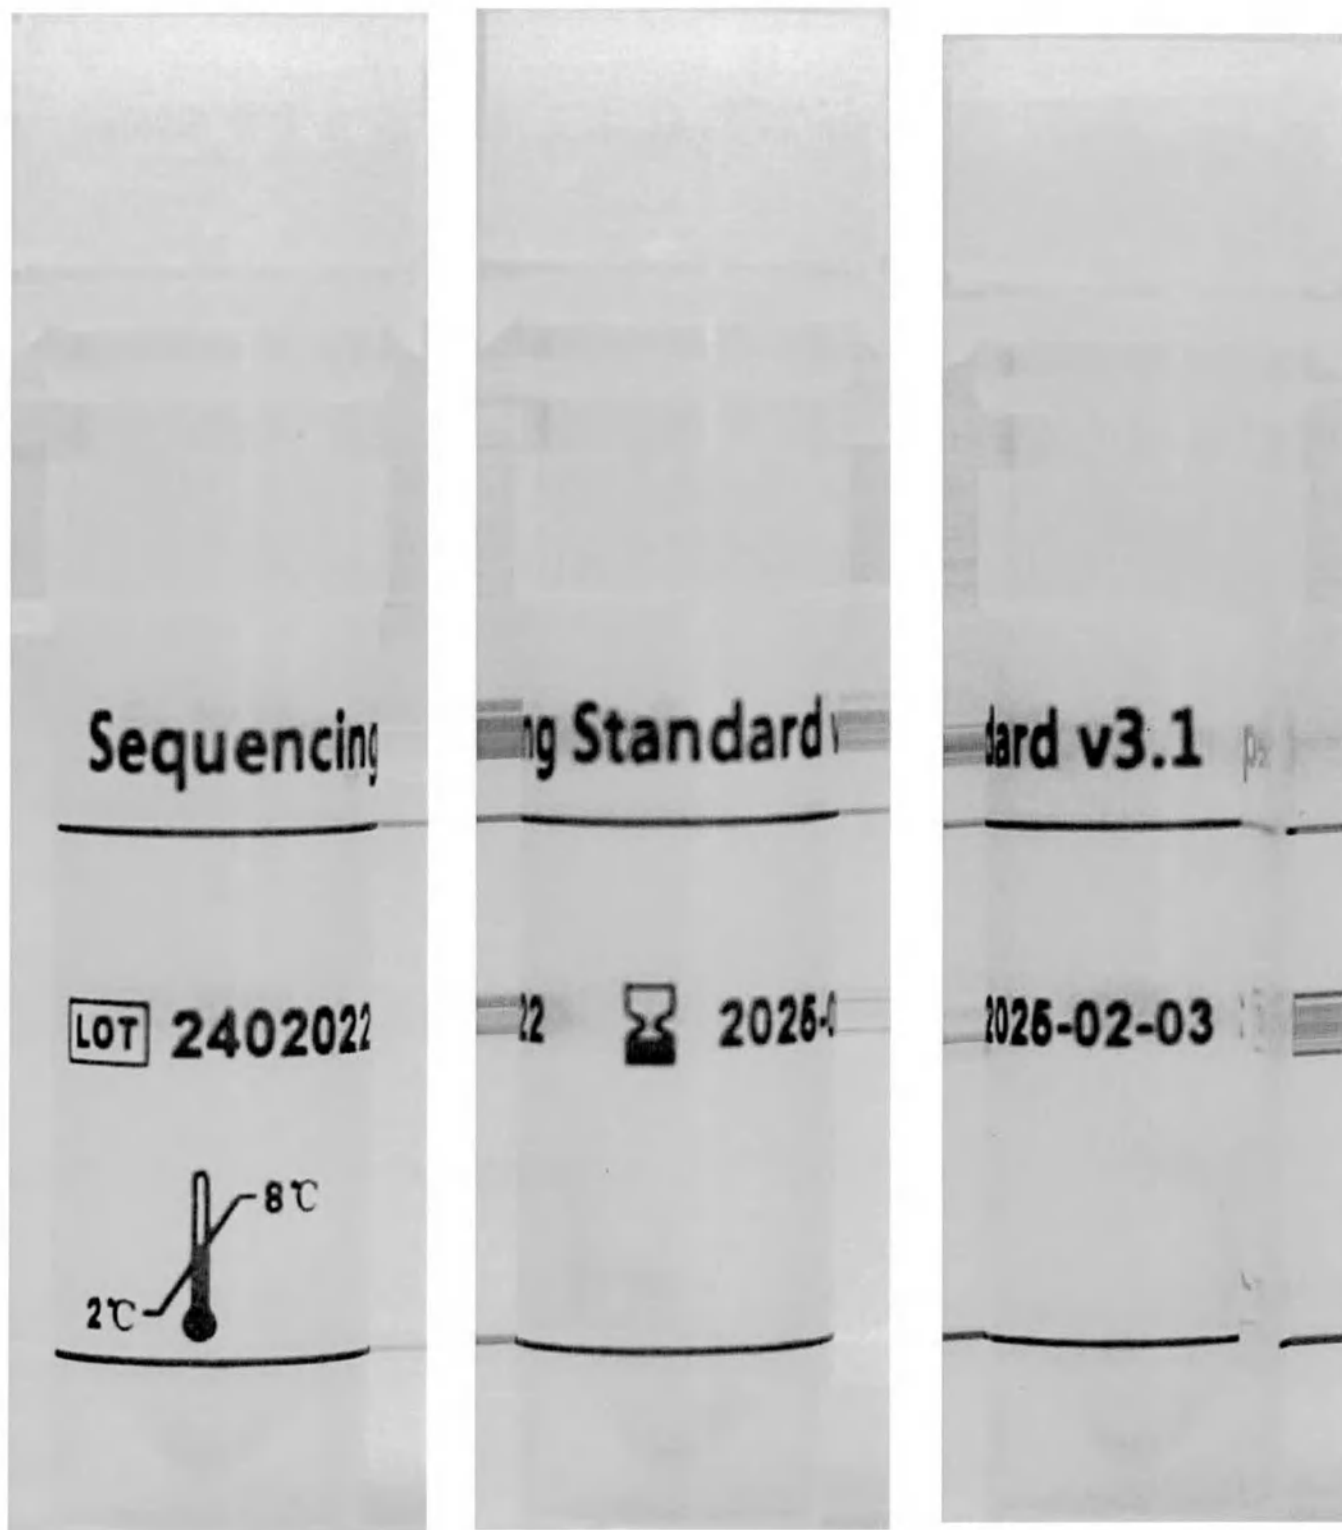

Стандарт для секвенирования v3.1 (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



Стандарт матричный 6-Dye (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями




Стандарт матричный для секвенирования 3.1 (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями




Стандарт для секвенирования v1.1 (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

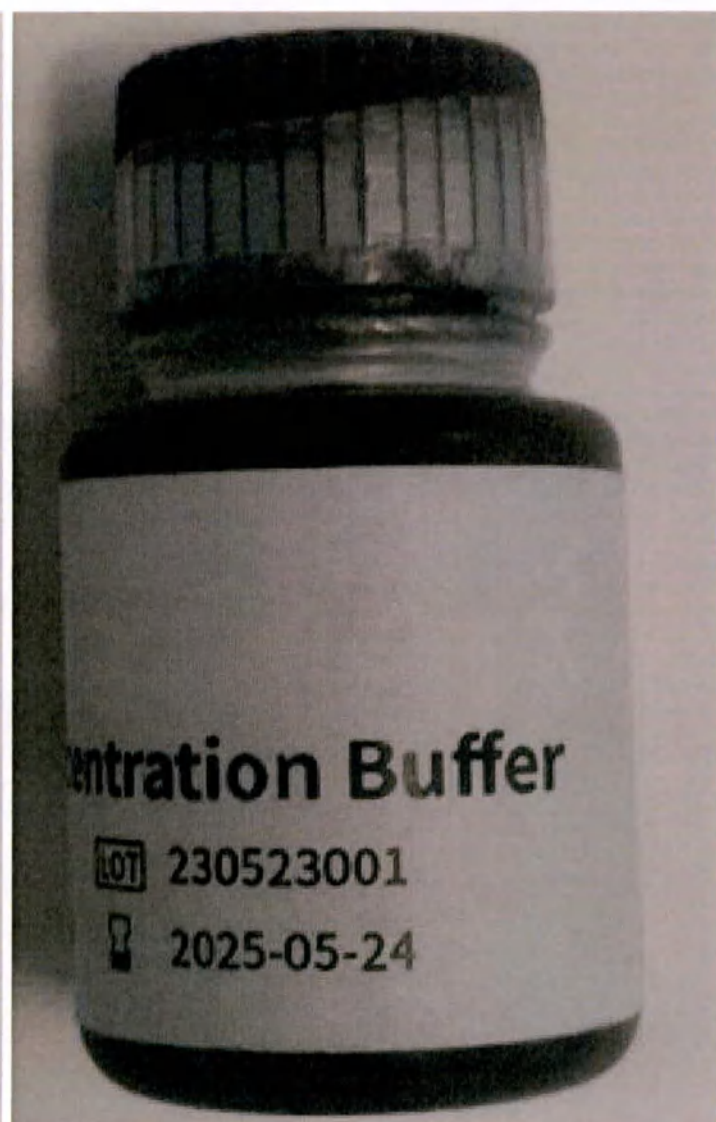


Буфер высокой концентрации 25 мл (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия Генетический анализатор (секвенатор) серии G с принадлежностями

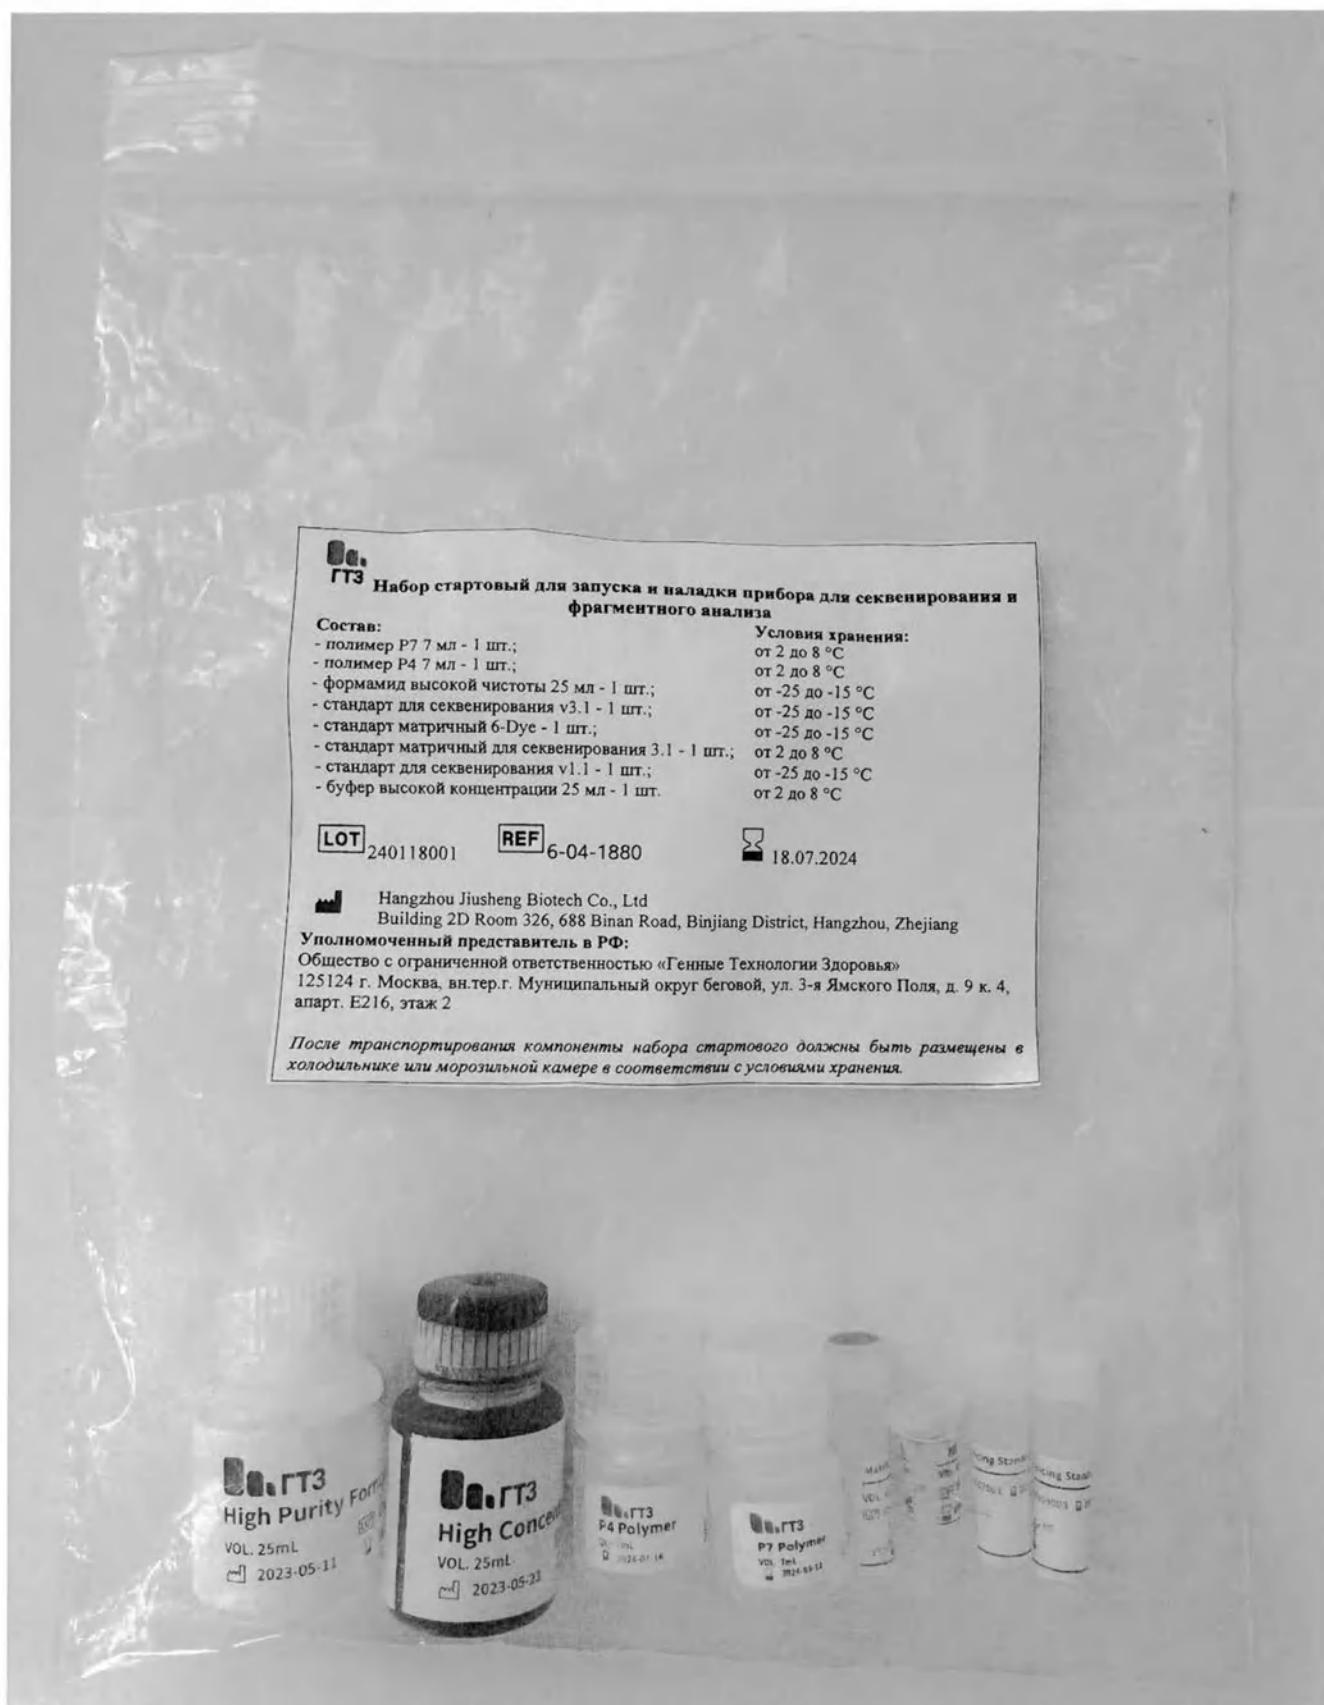

Набор стартовый для запуска и наладки прибора для секвенирования и фрагментного анализа в упаковке (Генетический анализатор (секвенатор) G08, Генетический анализатор (секвенатор) G16, Генетический анализатор (секвенатор) G24)

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями

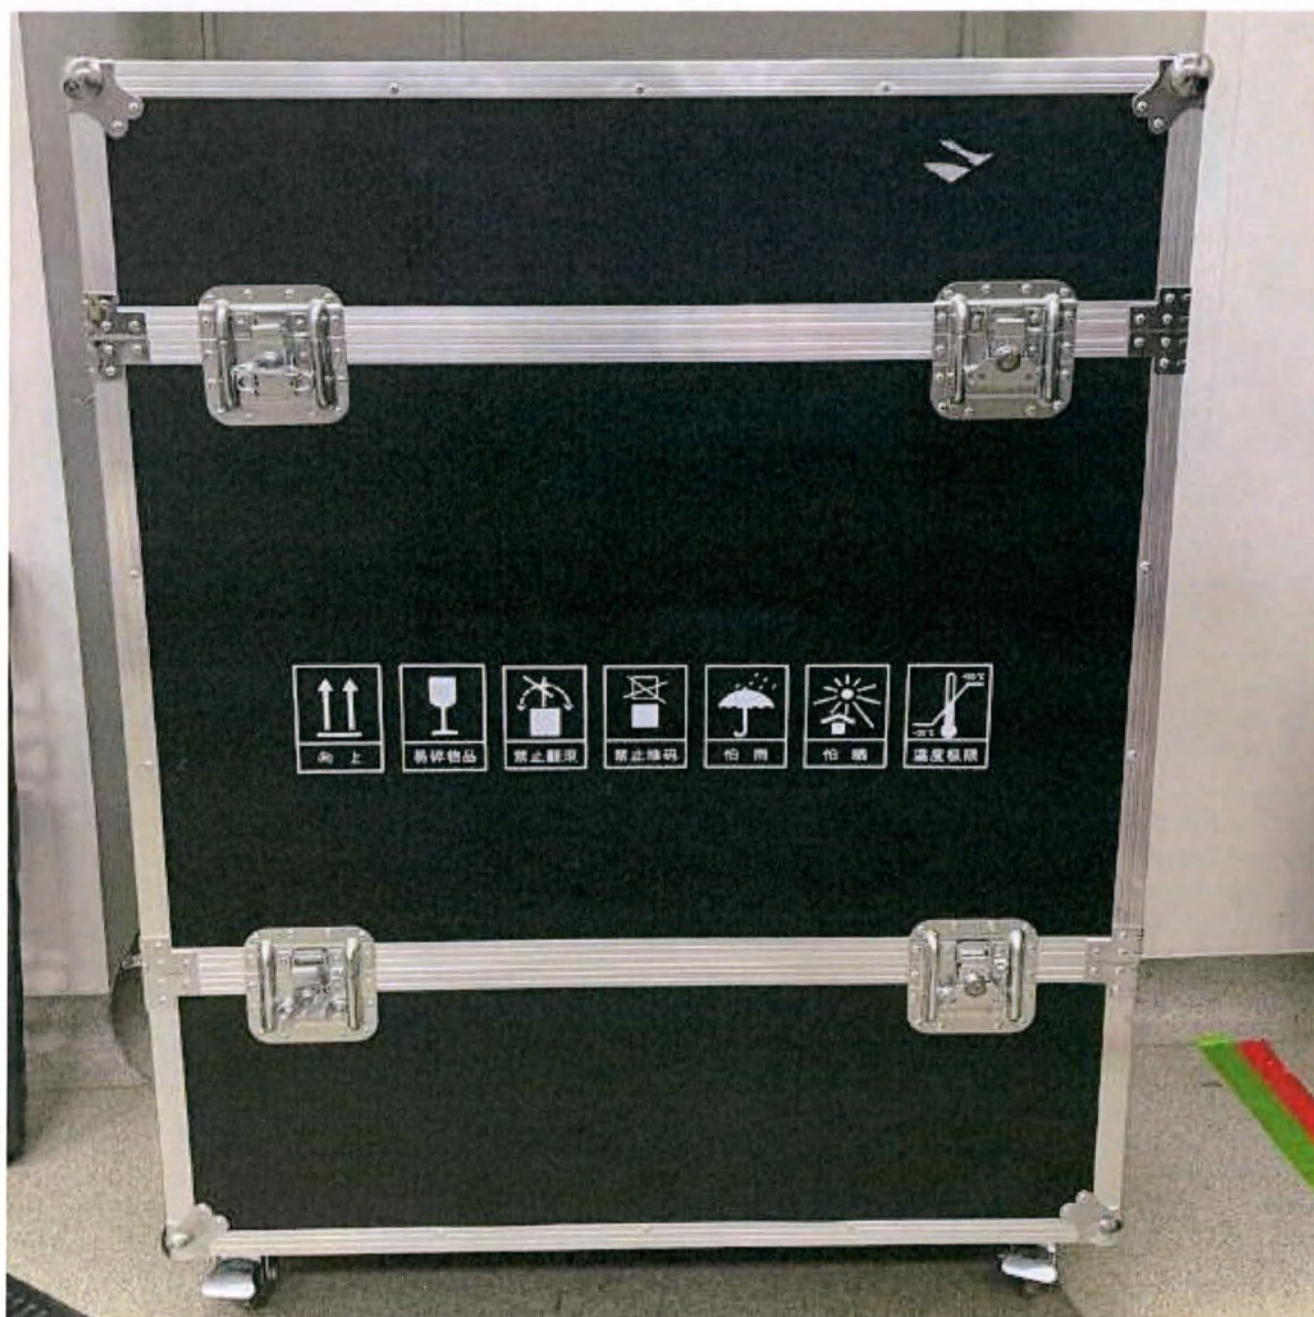

Транспортная упаковка (ракурс 1) генетического анализатора (секвенатора) серии G с принадлежностями

**Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями**



Транспортная упаковка (ракурс 2) генетического анализатора (секвенатора) серии G с принадлежностями

Фотографические изображения медицинского изделия **Генетический анализатор (секвенатор) серии G** **с принадлежностями**

Макеты маркировки

	Генетический анализатор (секвенатор) серии G с принадлежностями	
	Модель: _____	
	Номинальные электрические характеристики: 220 В ~; 50 Гц	
	Потребляемая мощность: 500 ВА	
	S\N _____	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.		
	Hangzhou Jiusheng Biotech Co., Ltd Building 2D Room 326, 688 Binan Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China	
		
		

Макет маркировки генетического анализатора (секвенатора) серии G с принадлежностями

	Генетический анализатор (секвенатор) серии G с принадлежностями	
	Модель	
		
	Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.	
		Hangzhou Jiusheng Biotech Co., Ltd Building 2D Room 326, 688 Binan Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Генные Технологии Здоровья» 125124 г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 9 к. 4, апарт. E216, этаж 2 Тел.: +7-909-686-0077; +7-966-140-5599		
		
		
		

Макет маркировки транспортной упаковки

Фотографические изображения медицинского изделия
Генетический анализатор (секвенатор) серии G
с принадлежностями



**Набор стартовый для запуска и наладки прибора для секвенирования и
фрагментного анализа**

Состав:

- полимер P7 7 мл - 1 шт.;
- полимер P4 7 мл - 1 шт.;
- формамид высокой чистоты 25 мл - 1 шт.;
- стандарт для секвенирования v3.1 - 1 шт.;
- стандарт матричный 6-Dye - 1 шт.;
- стандарт матричный для секвенирования 3.1 - 1 шт.;
- стандарт для секвенирования v1.1 - 1 шт.;
- буфер высокой концентрации 25 мл - 1 шт.

Условия хранения:

- от 2 до 8 °C
- от 2 до 8 °C
- от -25 до -15 °C
- от -25 до -15 °C
- от -25 до -15 °C
- от 2 до 8 °C
- от -25 до -15 °C
- от 2 до 8 °C

LOT

REF



Hangzhou Jiusheng Biotech Co., Ltd
Building 2D Room 326, 688 Binan Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Генные Технологии Здоровья»
125124 г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ беговой, ул. 3-я Ямского Поля, д. 9 к. 4,
апарт. E216, этаж 2

После транспортирования компоненты набора стартового должны быть размещены в холодильнике или морозильной камере в соответствии с условиями хранения.


**Макет маркировки Набора для запуска и наладки прибора для секвенирования
и фрагментного анализа**

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью, общим числом

58 (пятьдесят восемь) листов.

Генеральный директор ООО «ГТЗ»

Адамян Л.А.



М.П.

