

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТРЕЙТ»

Романадзе М.О.

02 сентября 2024 г.




Фотографические изображения медицинского изделия
«Ортопедические элементы Системы имплантационной
стоматологической ROOTT»



Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм; A1K Абатмент односоставной, Н 1 мм; A2K Абатмент односоставной, Н 2 мм;
A3K Абатмент односоставной, Н 3 мм; A4K Абатмент односоставной, Н 4 мм.

* внешний вид всех абатментов односоставных и их комплектация идентичны: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке

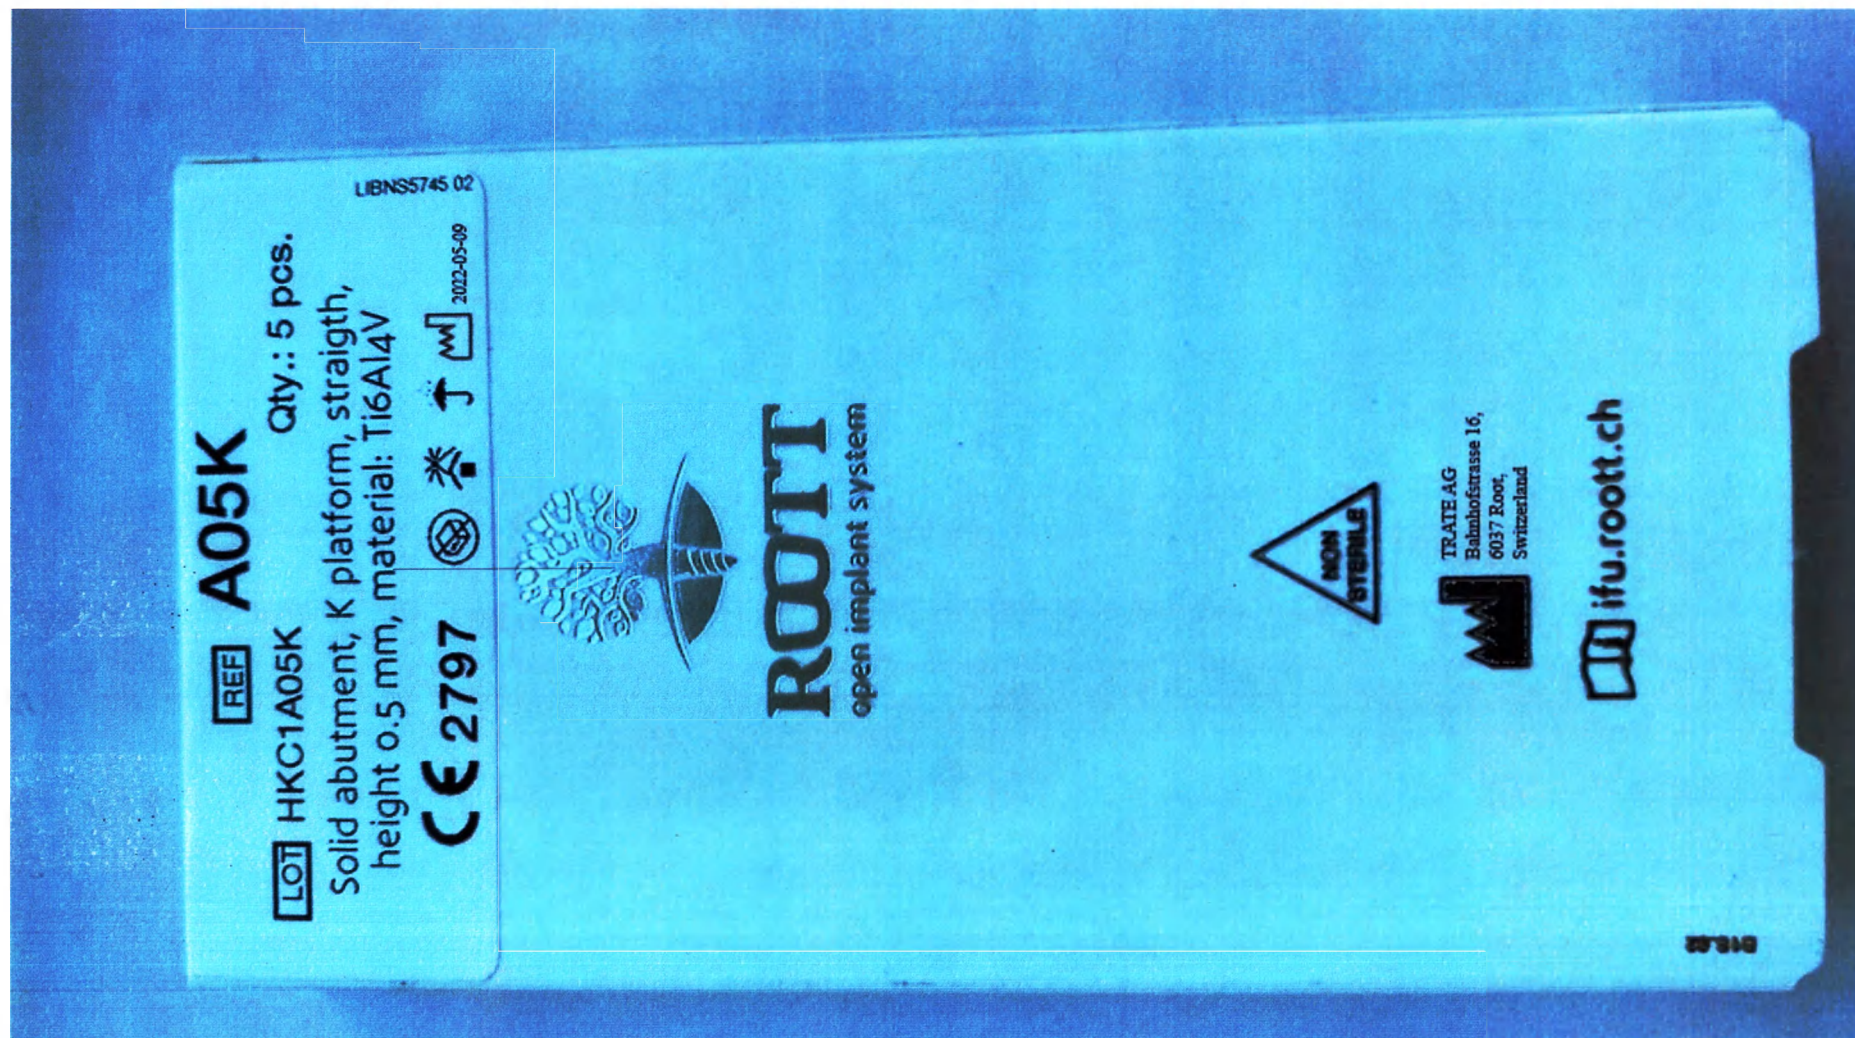


Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм. (коробка для блистеров)

*Все односоставные абатменты имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм (блистер, маркировка).
 *Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



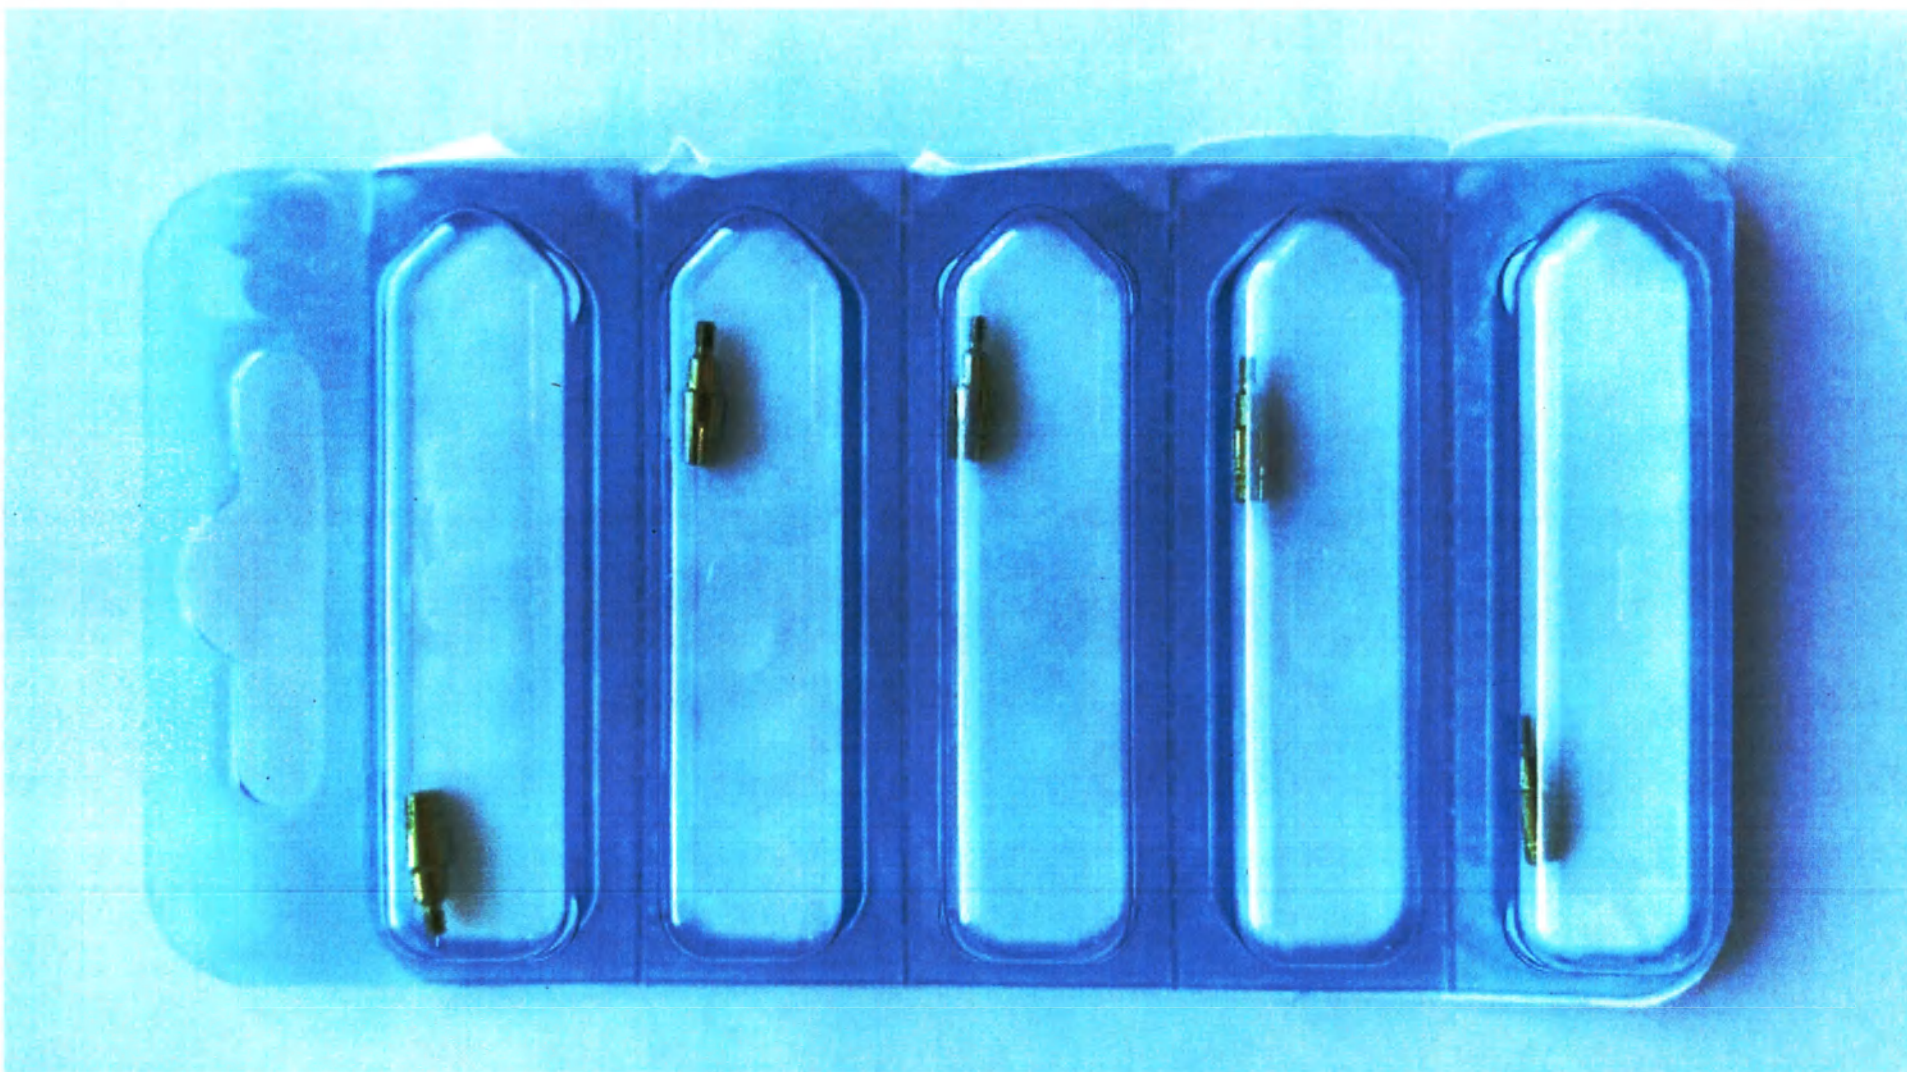


Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм (изделия в блистере в комплектации).

REF	A05K	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент односоставной, Н 0.5 мм материал: Ti6Al4V Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм

*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**

*** Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

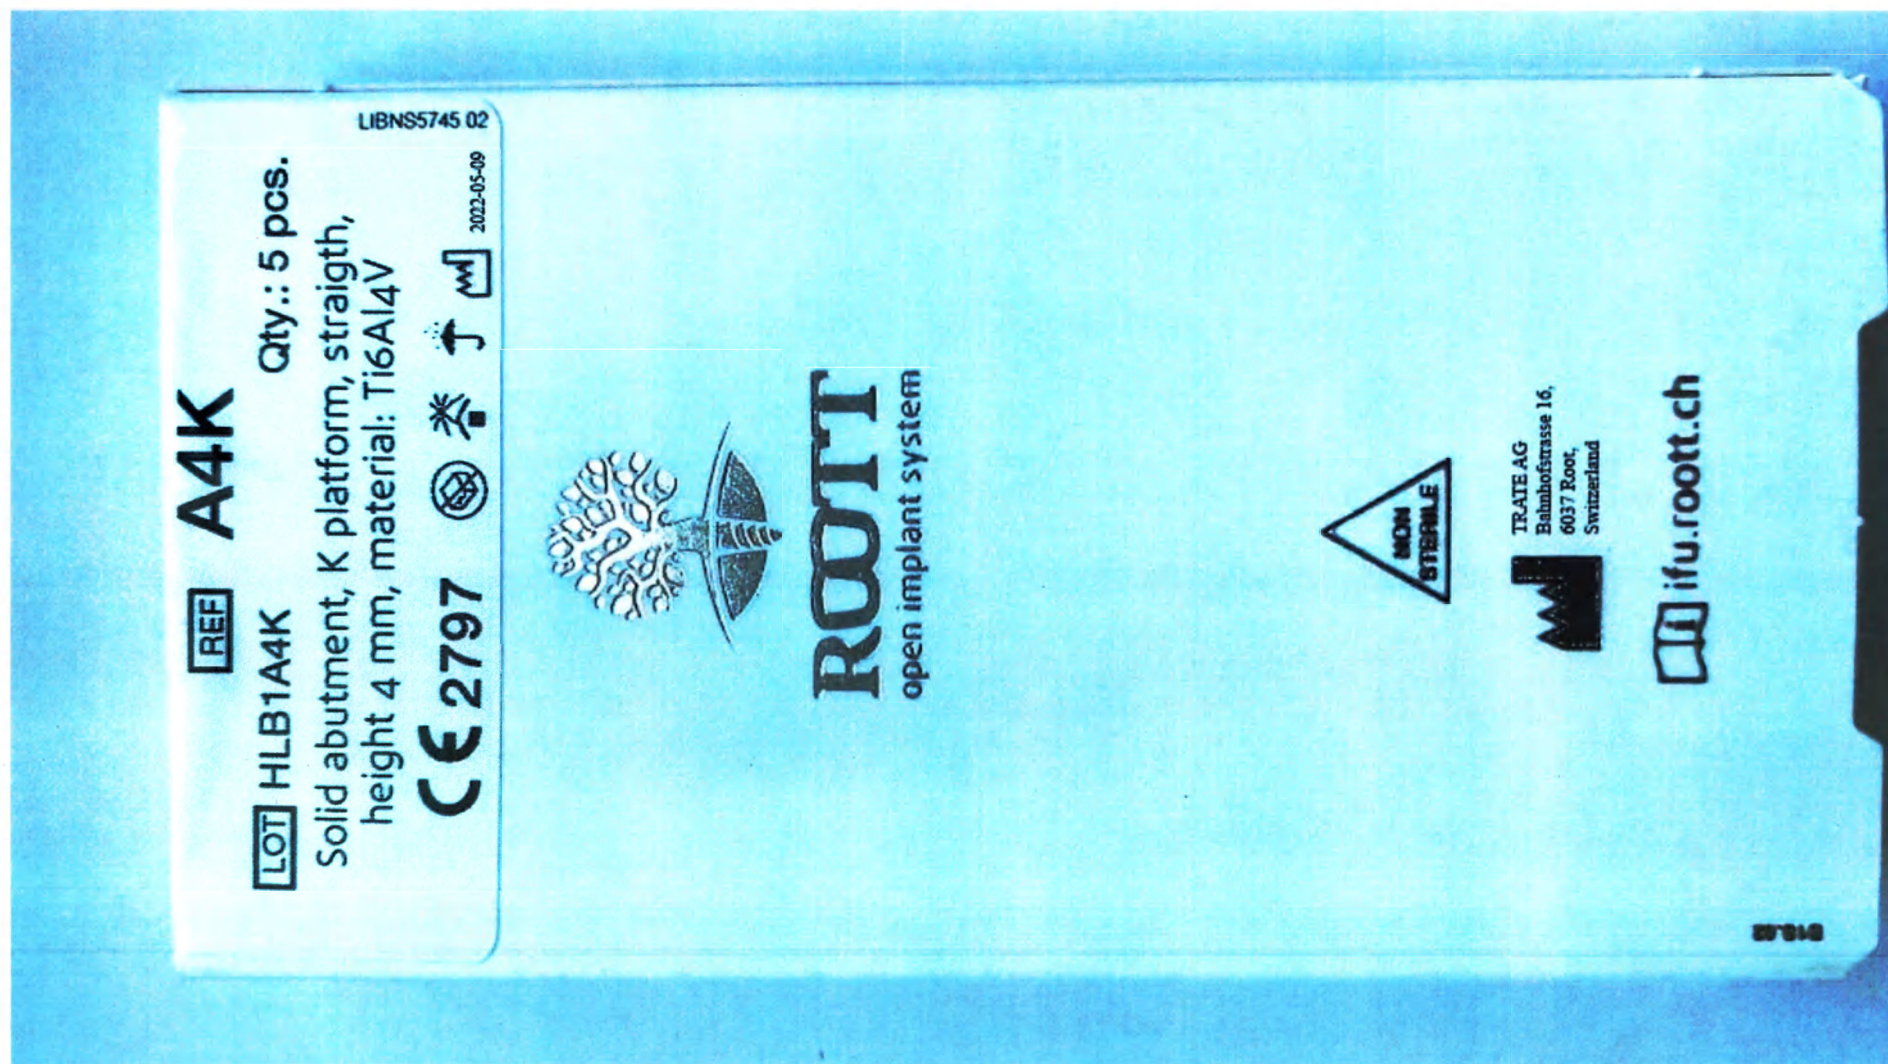

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4K Абатмент односоставной, Н 4 мм. (коробка для блистеров)

*Все односоставные абатменты имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4K Абатмент односоставной, Н 4 мм. (блистер, маркировка)
 * Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства
 (где применимо).





Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: А4К Абатмент односоставной, Н 4 мм. (изделия в блистере в комплектации)

REF	A4K	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент односоставной, Н 4 мм материал: Ti6Al4V Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: А4К Абатмент односоставной, Н 4 мм


* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A2K Абатмент односоставной, Н 2 мм. (коробка для блистеров)

*Все односоставные абатменты имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

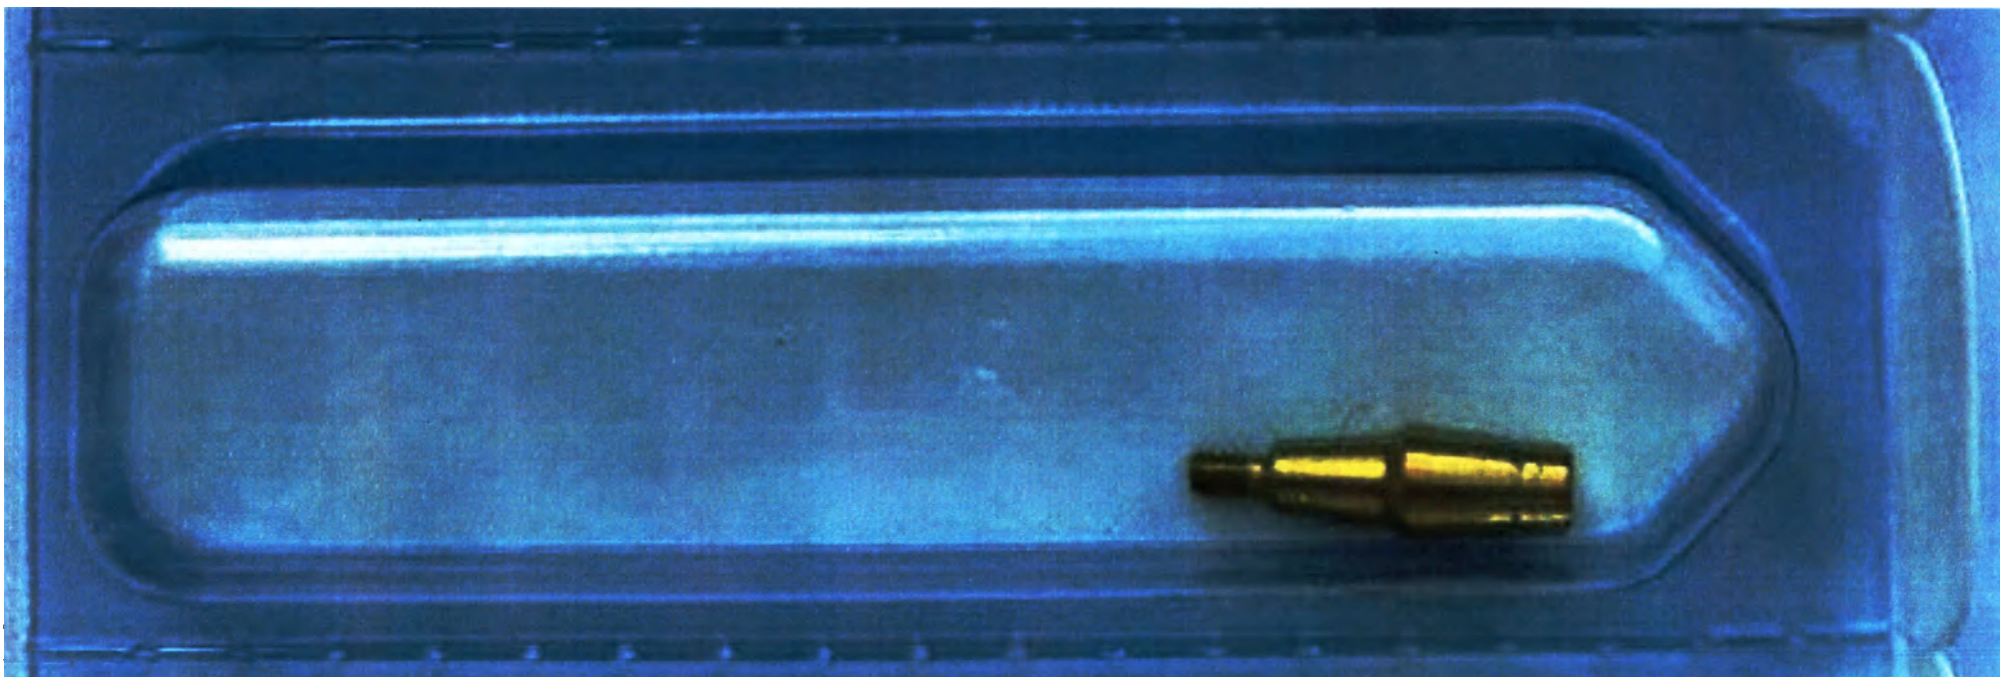

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: А2К Абатмент односоставной, Н 2 мм. (изделие в блистере в комплектации)

REF	A2K	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент односоставной, Н 2 мм материал: Ti6Al4V Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A2K Абатмент односоставной, Н 2 мм

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке


* Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).




Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A3K Абатмент односоставной, Н 3 мм. (коробка для блистеров)

*Все односоставные абатменты имеют идентичную упаковку и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

Абатмент одноставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A3K Абатмент одноставной, Н 3 мм. (блистер, маркировка)
 *Все одноставные абатменты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства
 (где применимо).

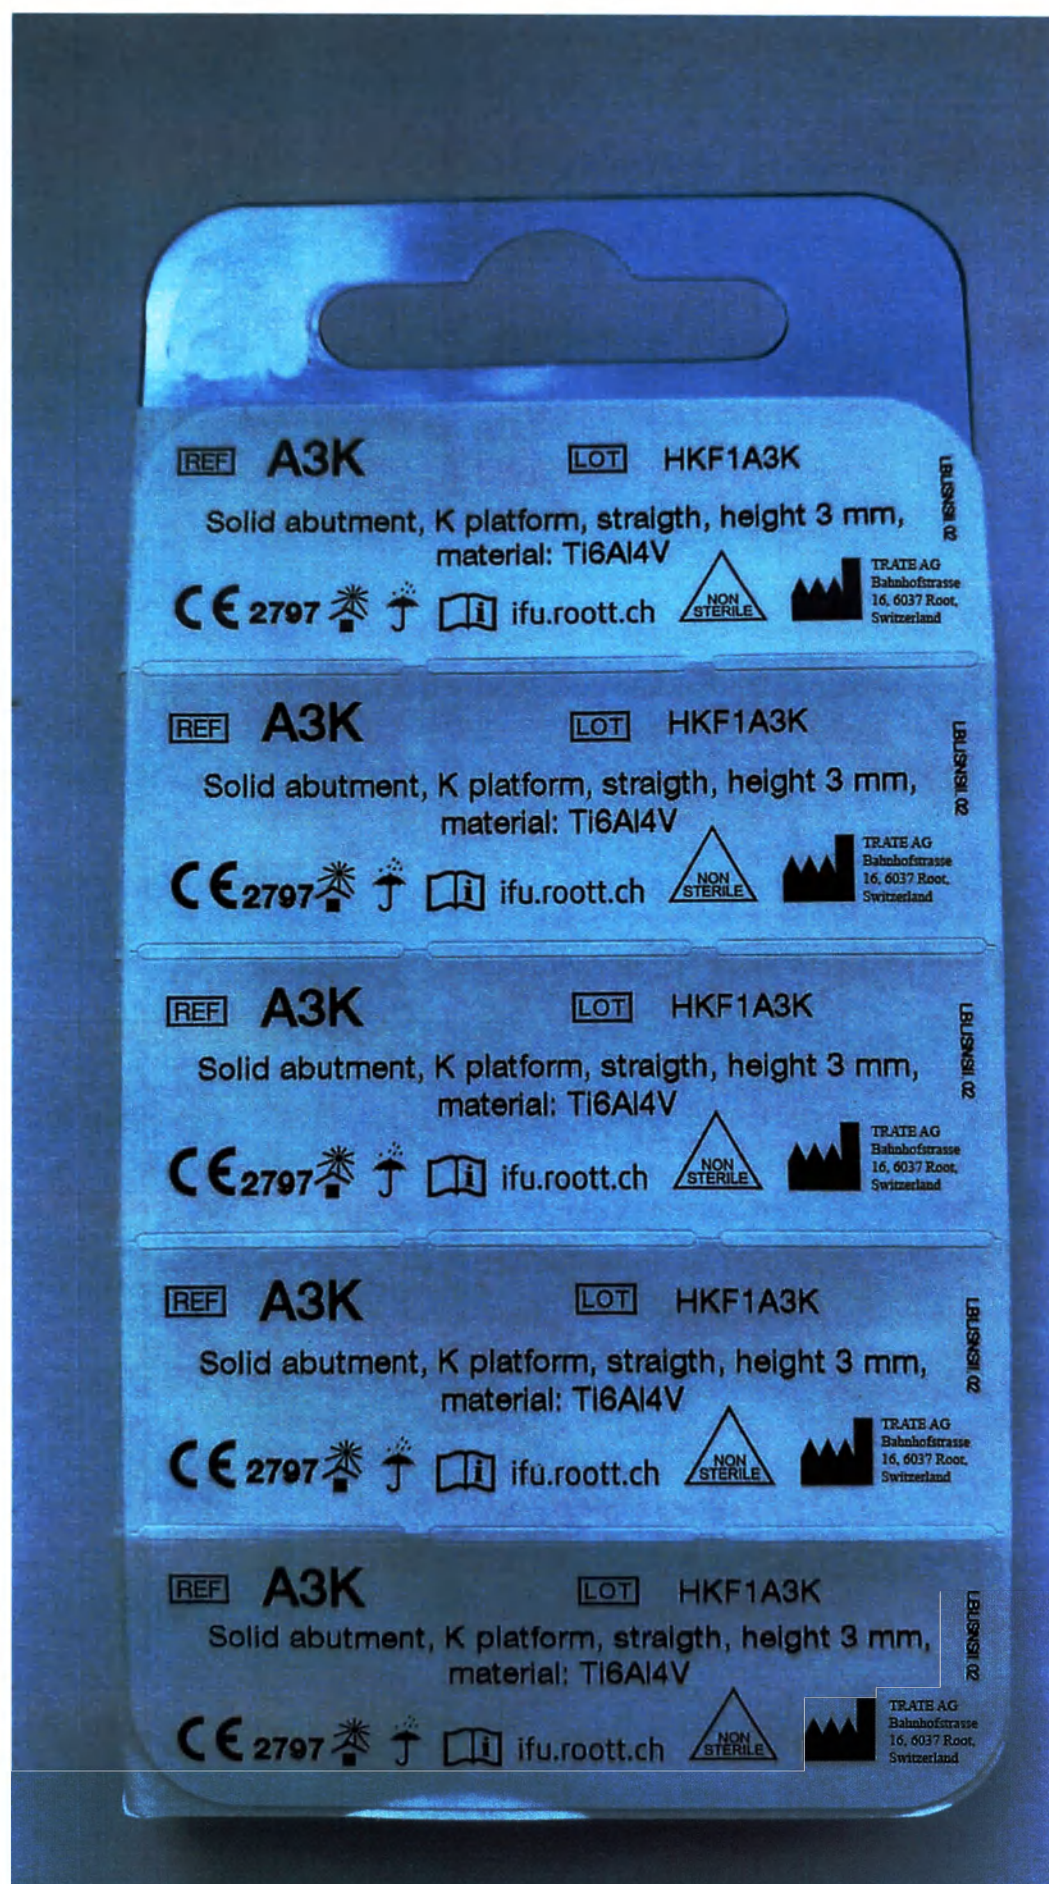

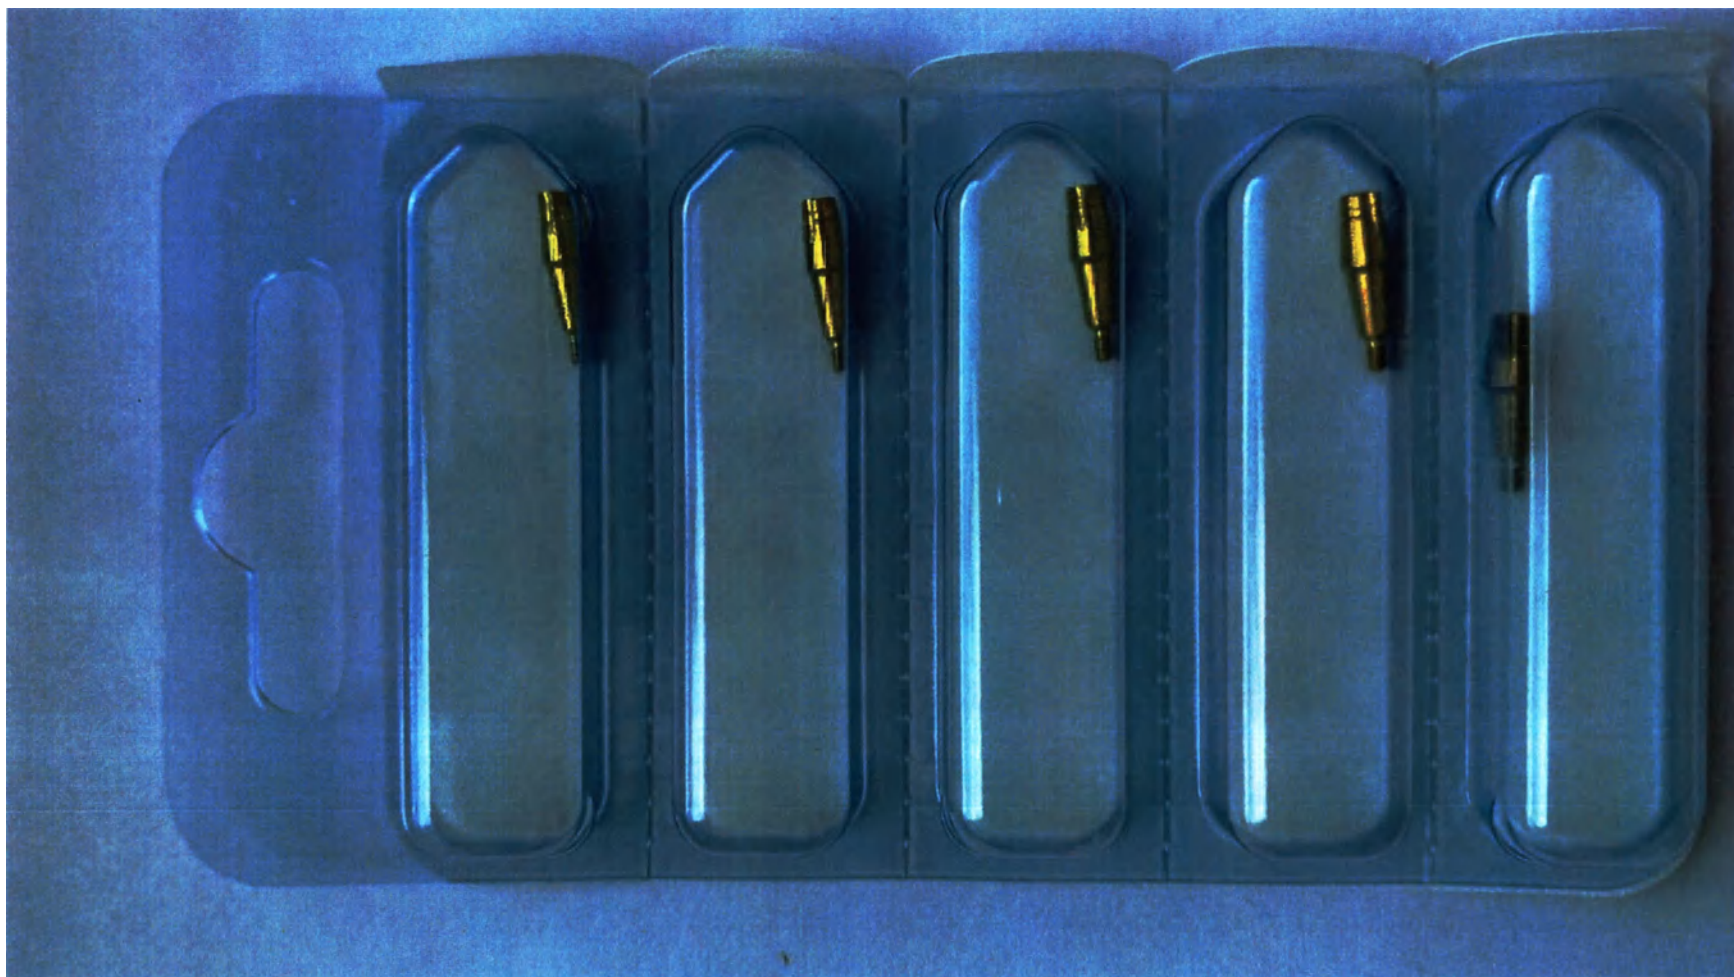

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: АЗК Абатмент односоставной, Н 3 мм. (изделия в блистере в комплектации)

REF	A3K	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент односоставной, Н 3 мм					
материал: Ti6Al4V					
Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария					
Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX					
Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: А3К Абатмент односоставной, Н 3 мм

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

REF**A1K****LOT****XXX****XX XXXX**

Абатмент односоставной, Н 1 мм

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A1K Абатмент односоставной, Н 1 мм

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: ESK Абатмент односоставной. К
* внешний вид всех абатментов односоставных и их комплектация идентичны: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке

REF

ESK

LOT

XXX




XX XXXX

Абатмент односоставной. К**материал: Ti6Al4V****Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария****Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX****Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать**

Макет этикетки на русском языке: Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: ESK Абатмент односоставной. К

*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**


*** Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

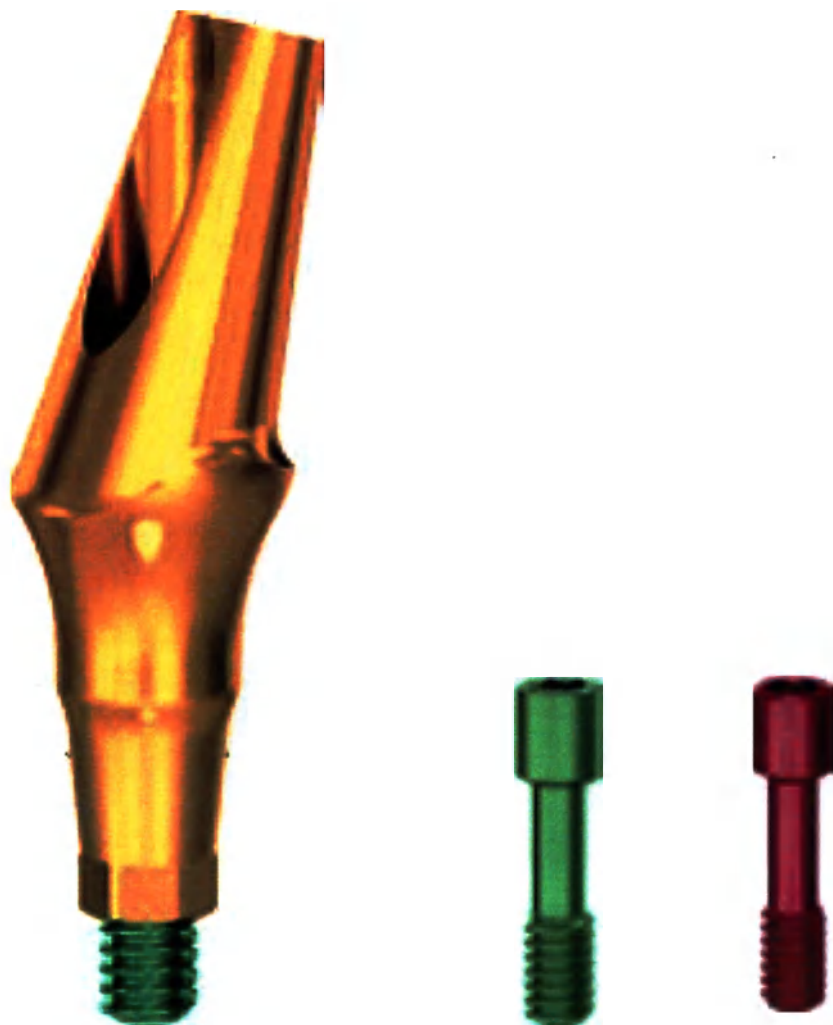

Абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

A1A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 1 мм.; A2A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 2 мм.; A3A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 3 мм.;
A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм.

* внешний вид всех абатментов узких угловых и их комплектация идентичны: 1 шт./блистер, комплектуются клиническим (зеленый) винтом и лабораторным (розовый) винтом, 5 блистеров в коробке

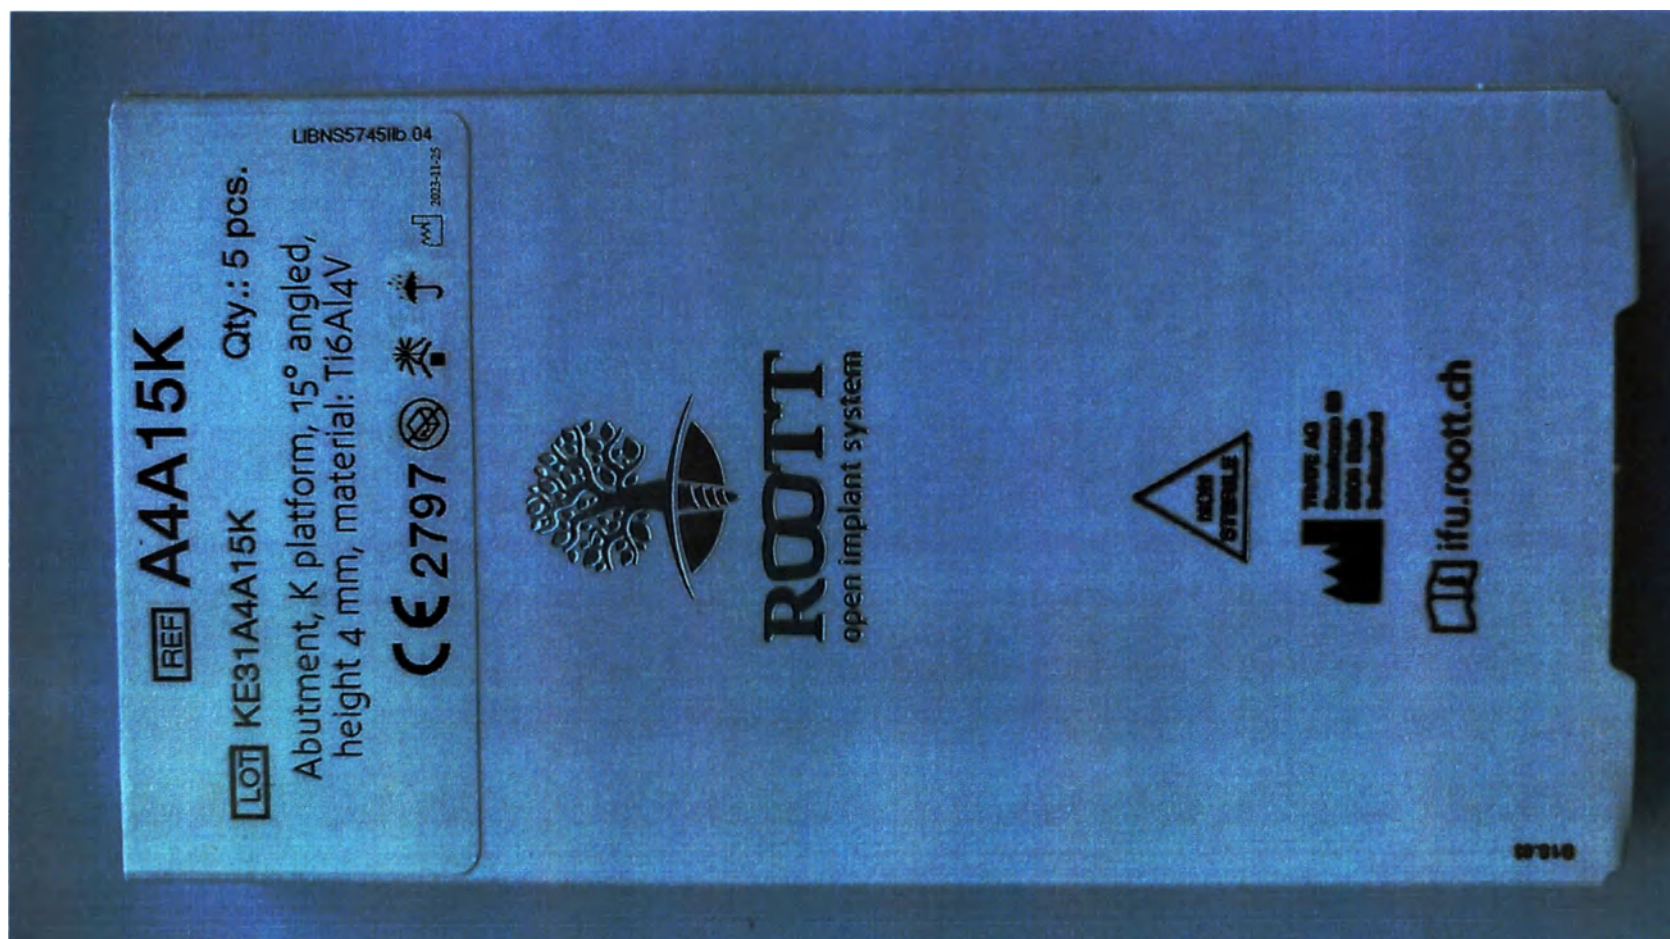

Абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм. (коробка для блистеров)

* Все абатменты узкие угловые имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм. (блистер, маркировка)

* Все абатменты узкие угловые имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм. (изделия в блистере в комплектации)

REF**A4A15K****LOT****XXX****XX XXXX**

Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, Н 4 мм

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все абатменты узкие угловые имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).




Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа.

* комплектация адаптеров выжигаемых прямых: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке




Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа (коробка для блистеров)

* Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

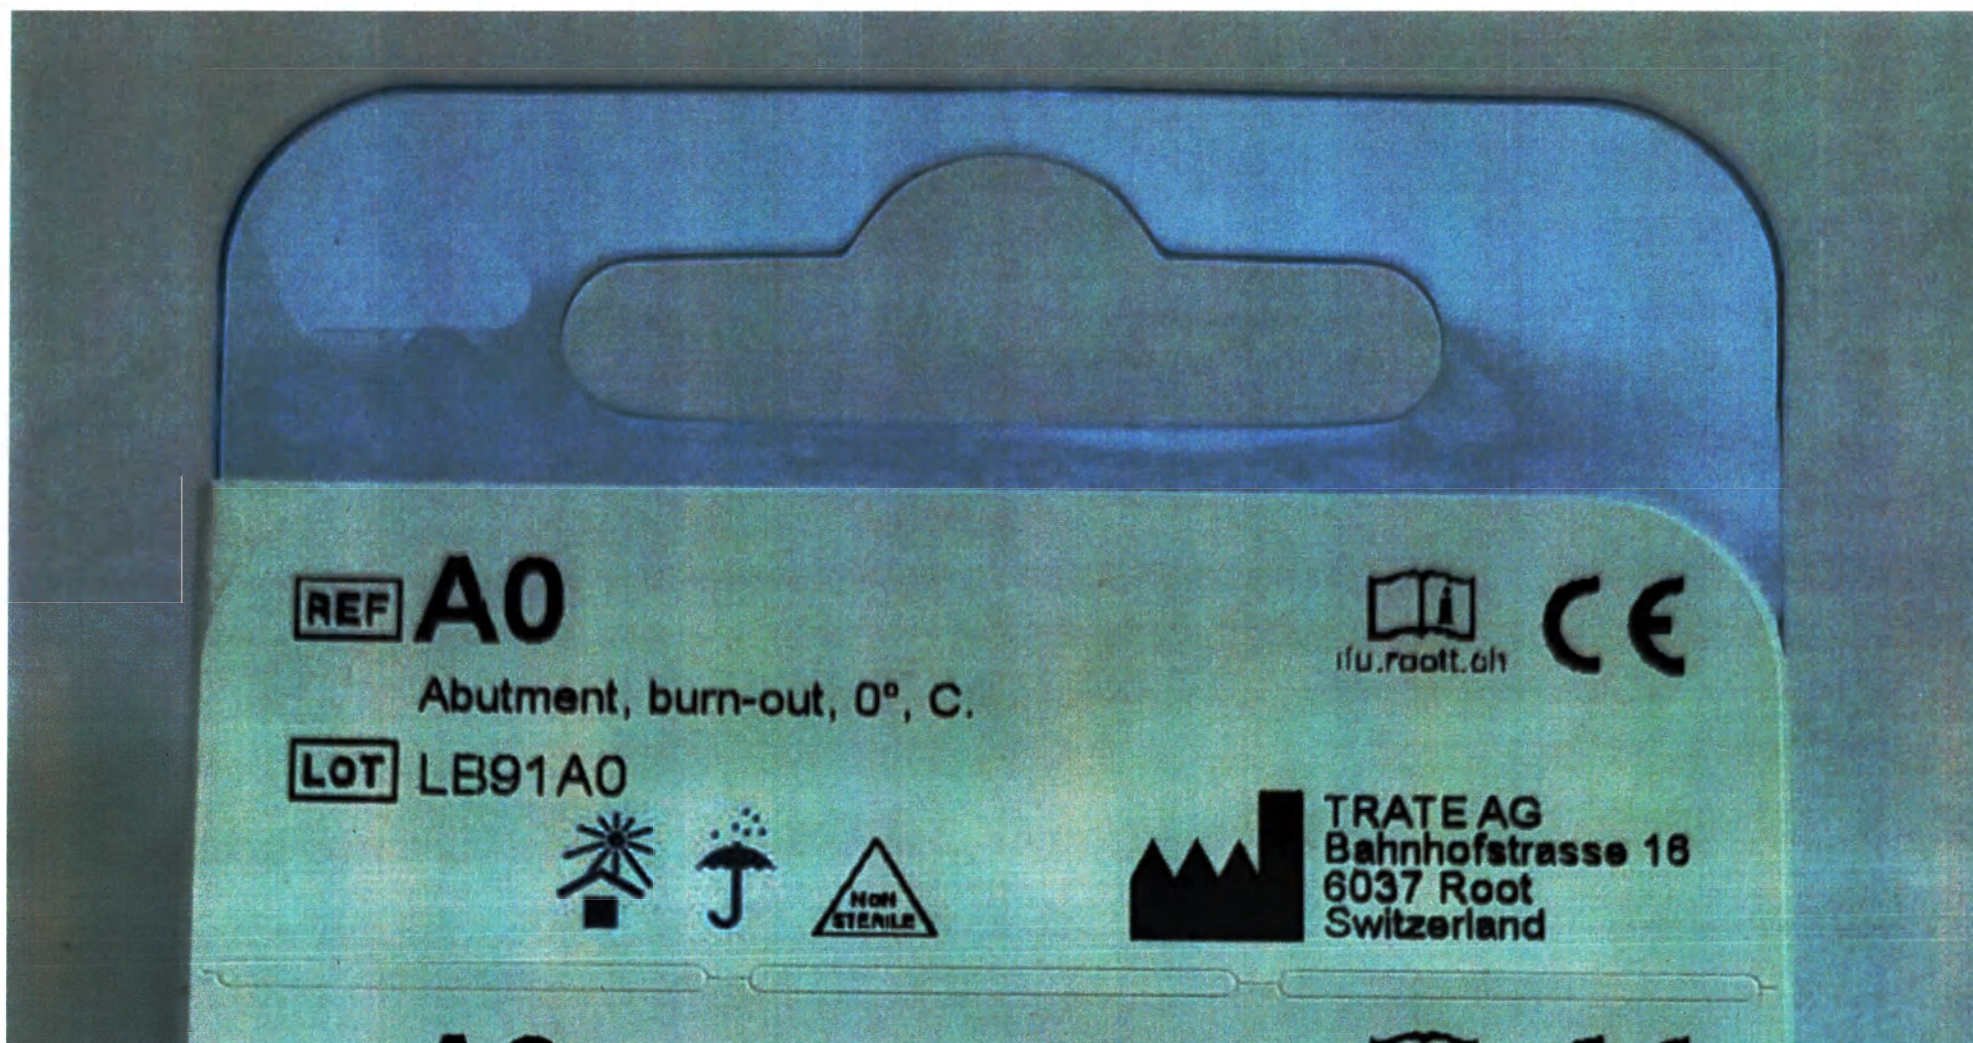

Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа. (блистер, маркировка)

* Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

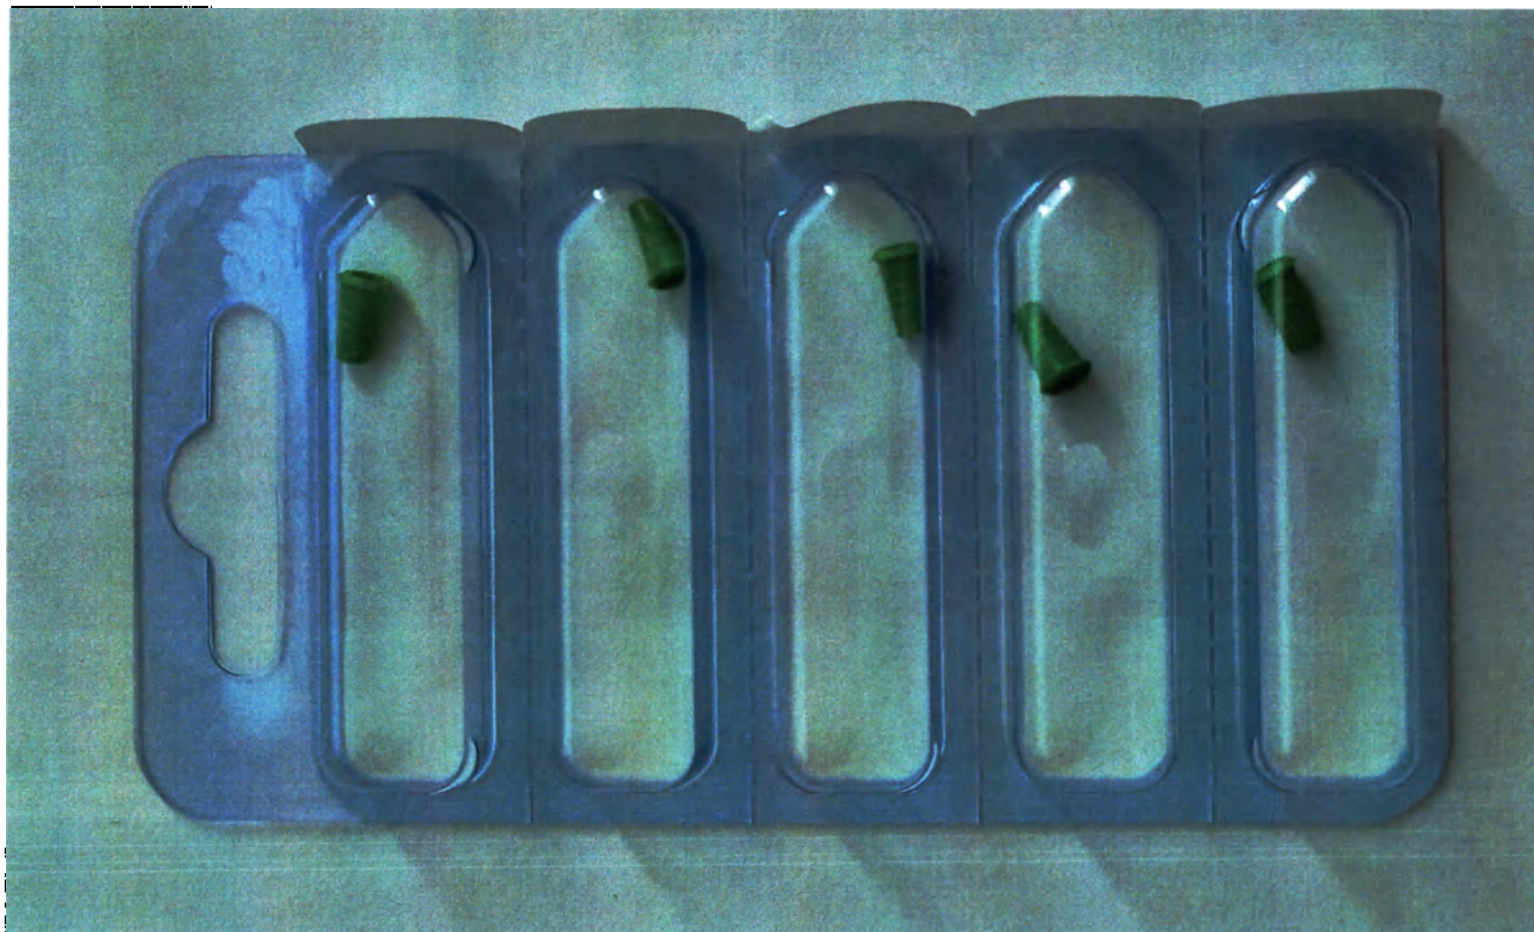

Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа (изделия в блистере в комплектации)

REF

A0

LOT

XXX



XX XXXX

Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа

материал: POM-C

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Адаптер, материал POM-C, варианты исполнения: A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа
*** комплектация всех адаптеров выжигаемых идентичная: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке**




Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа (коробка для блистеров)

* Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа (блистер, маркировка)

* Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

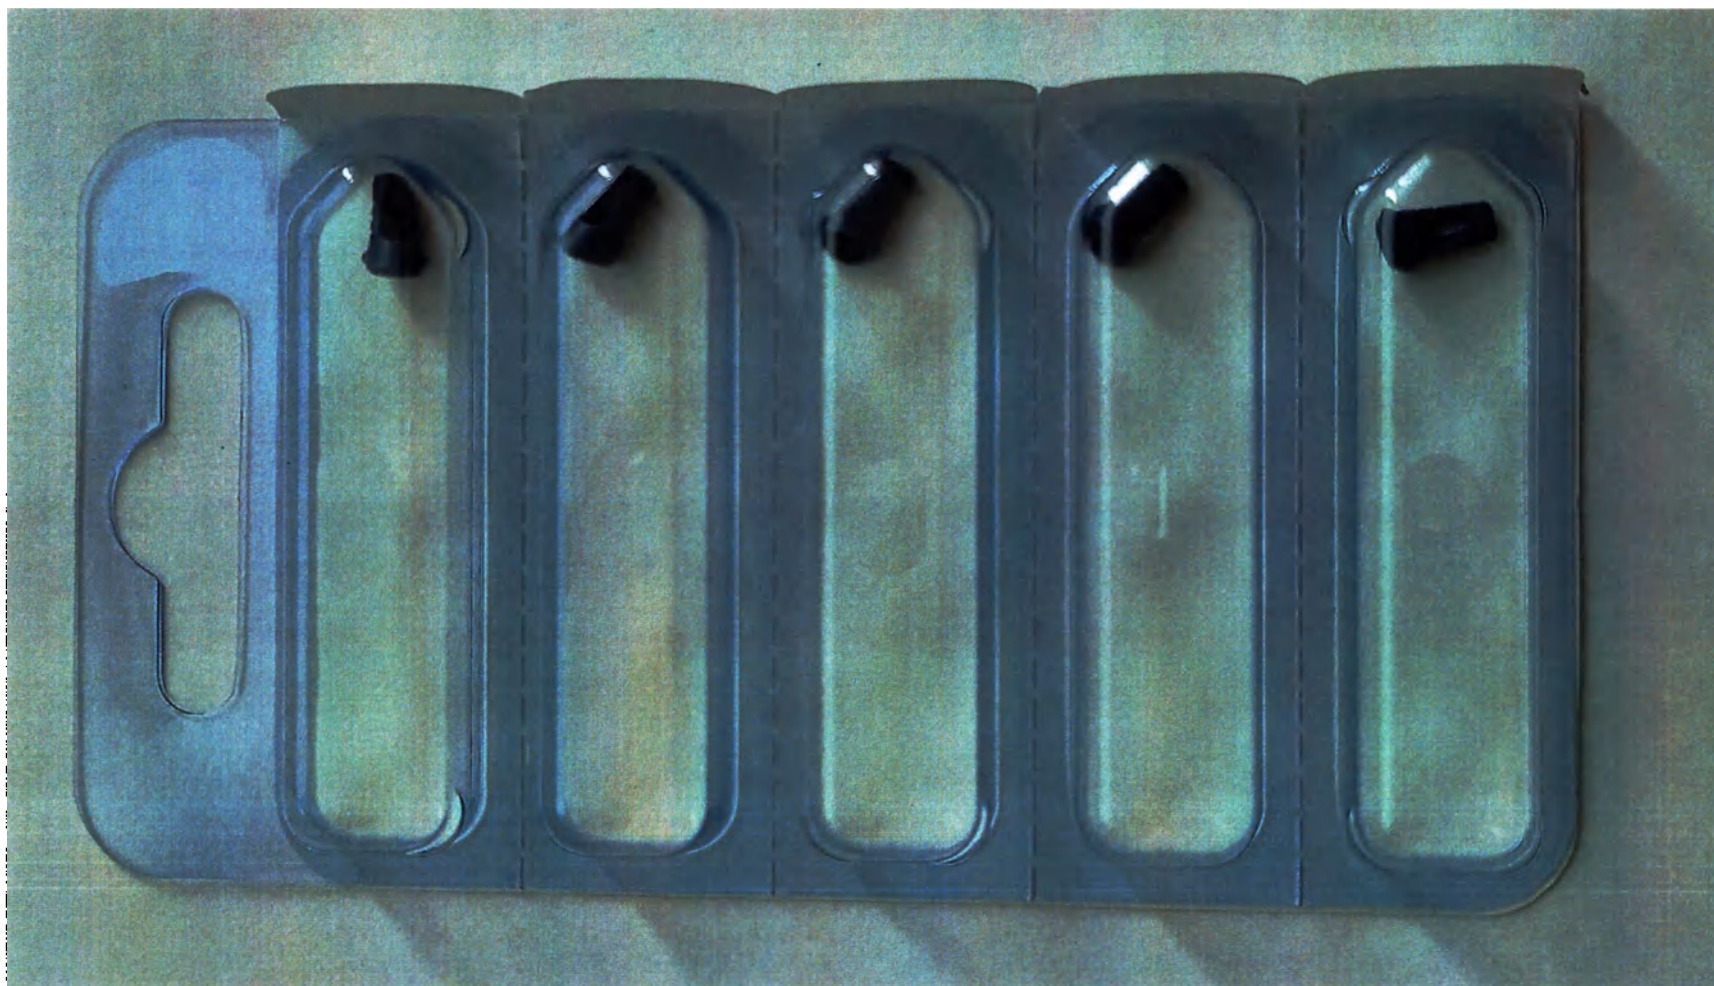

Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа (изделия в блистере в комплектации)

REF

A25

LOT

XXX



XX XXXX

Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа

материал: POM-C

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария


Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

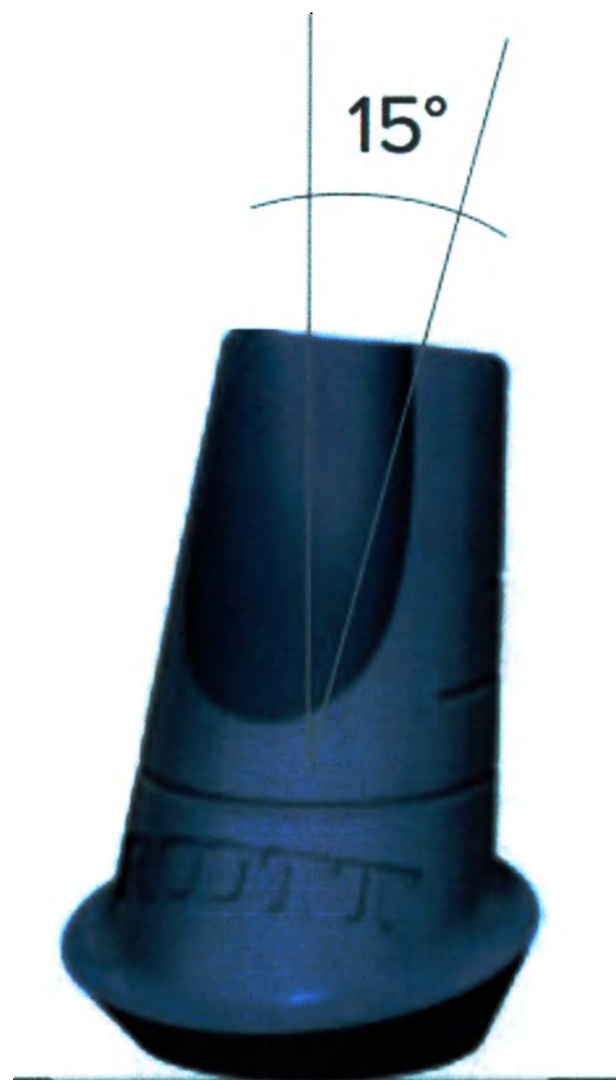

Адаптер, материал POM-C, варианты исполнения: A15 Адаптер выжигаемый, угловой 15°, внешняя платформа
*** комплектация всех адаптеров выжигаемых идентичная: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке**

REF

A15

LOT

XXX



XX XXXX

Адаптер выжигаемый, угловой 15°, внешняя платформа

материал: POM-C


Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX


Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Адаптер, материал POM-C, вариант исполнения: A15 Адаптер выжигаемый, угловой 15°, внешняя платформа

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все адаптеры выжигаемые имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

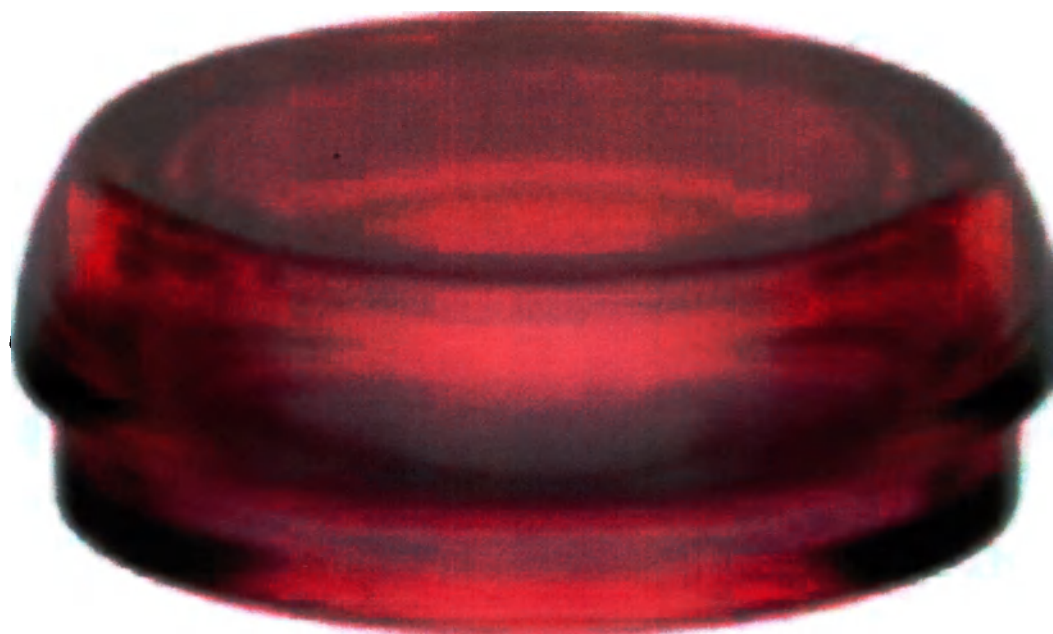


Ретенционная вставка, варианты исполнения: ВСП Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая
*** комплектация всех ретенционных вставок идентичная: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке**

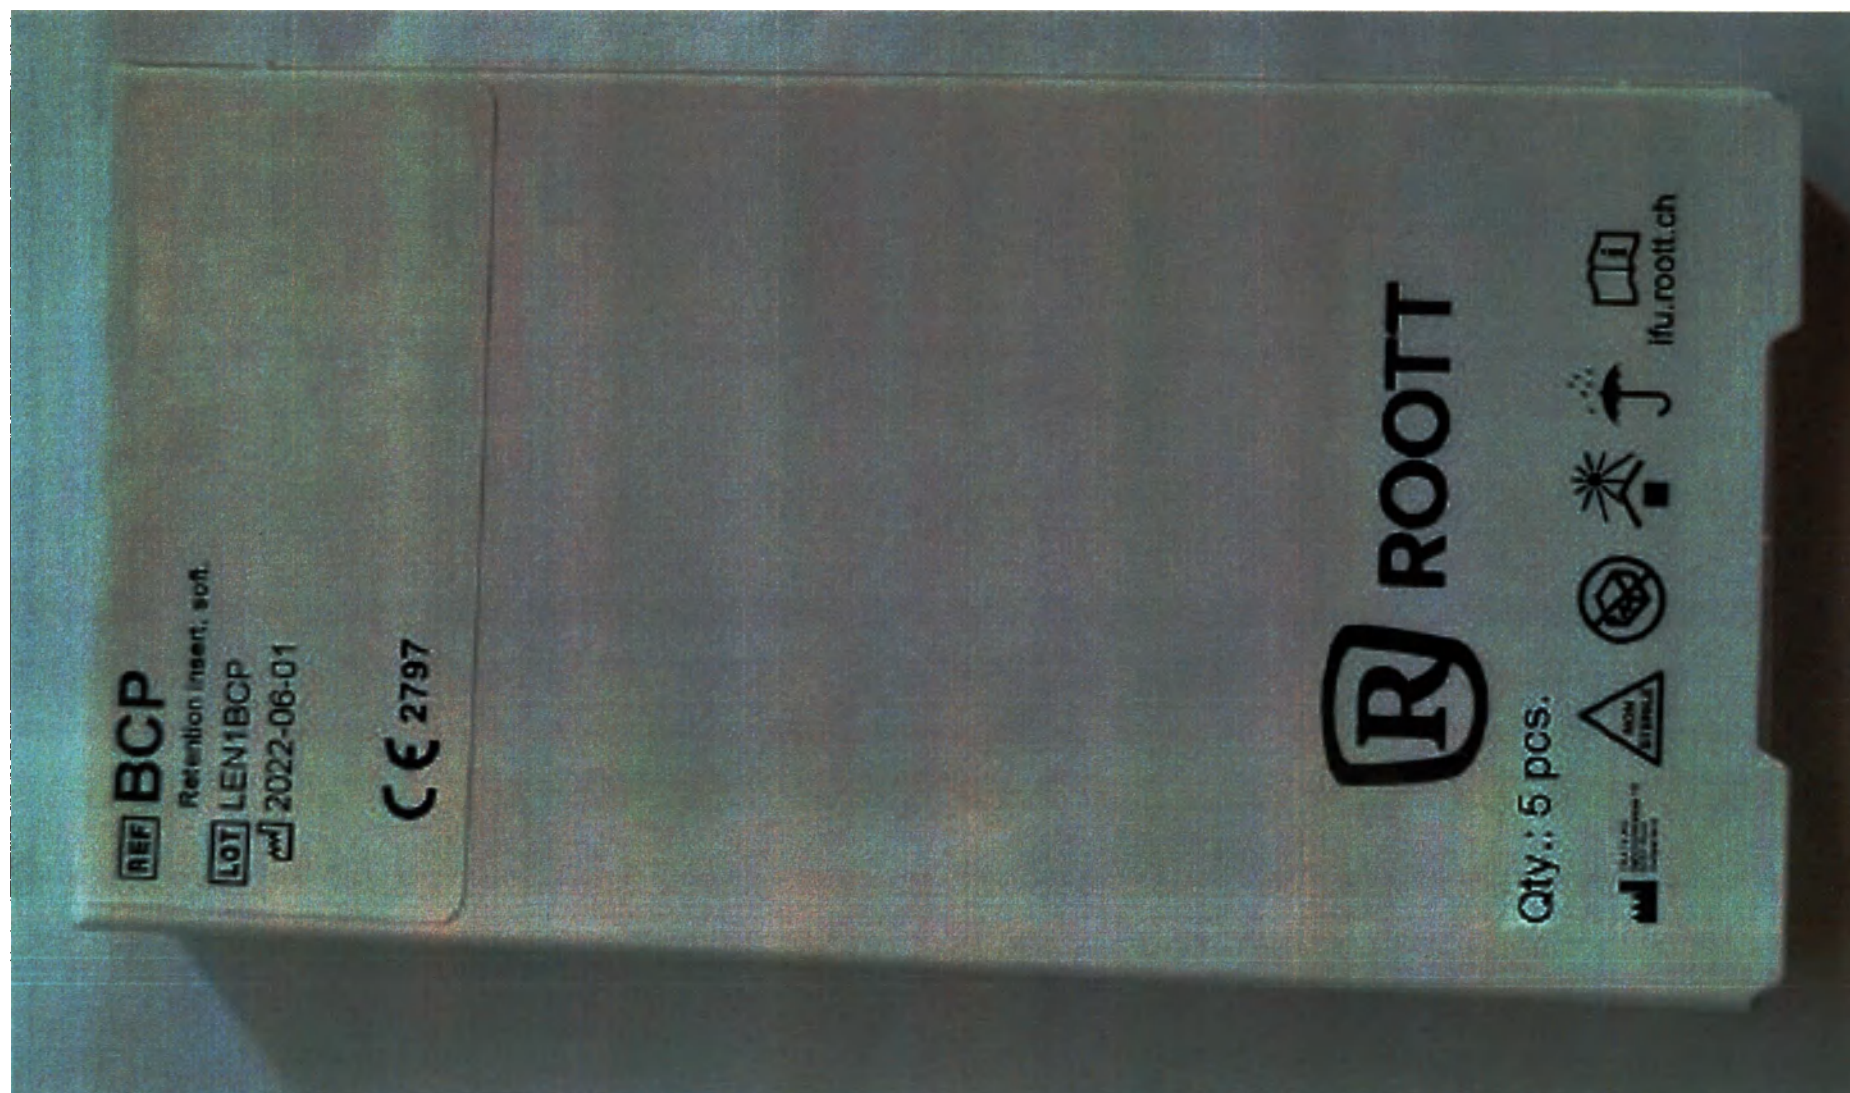


Ретенционная вставка, вариант исполнения: ВСП Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая (коробка для блистеров)

*** Все ретенционные вставки имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

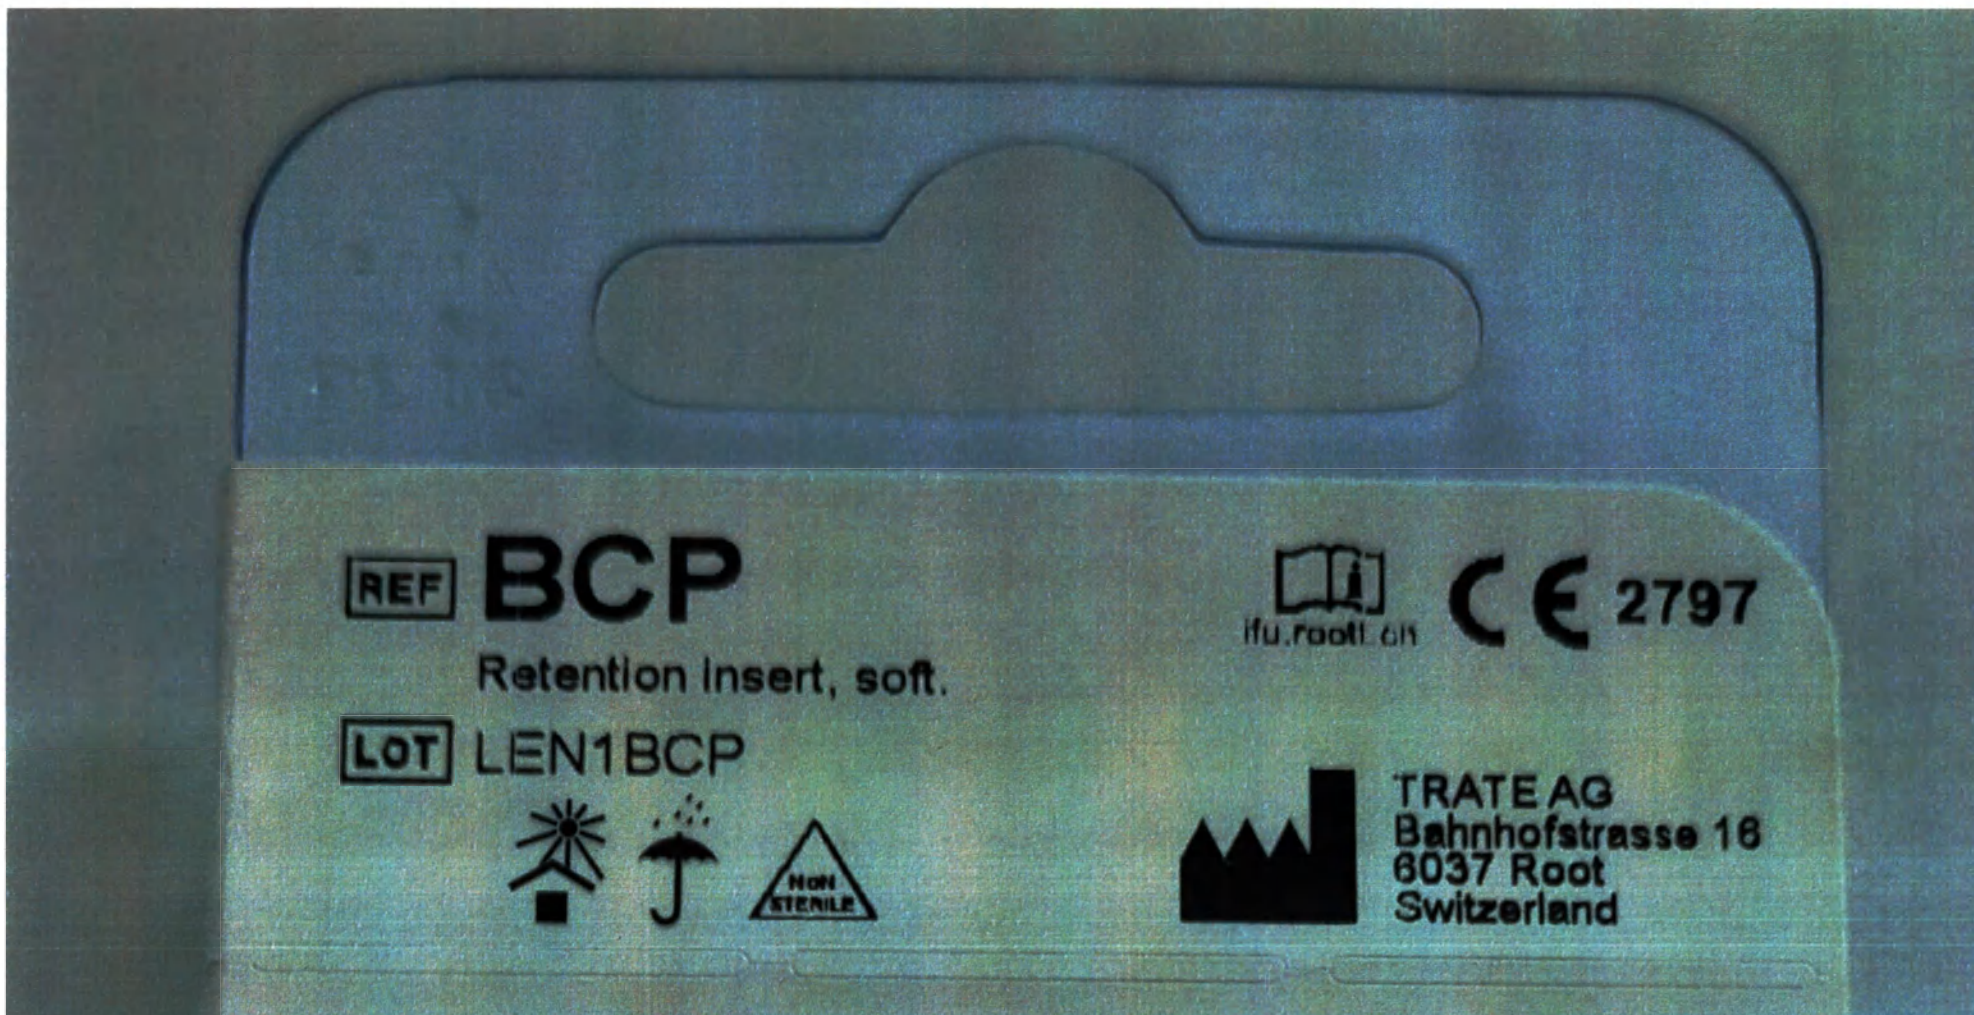

Ретенционная вставка, вариант исполнения: BCP Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая. (блистер, маркировка)

* Все Ретенционные вставки имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

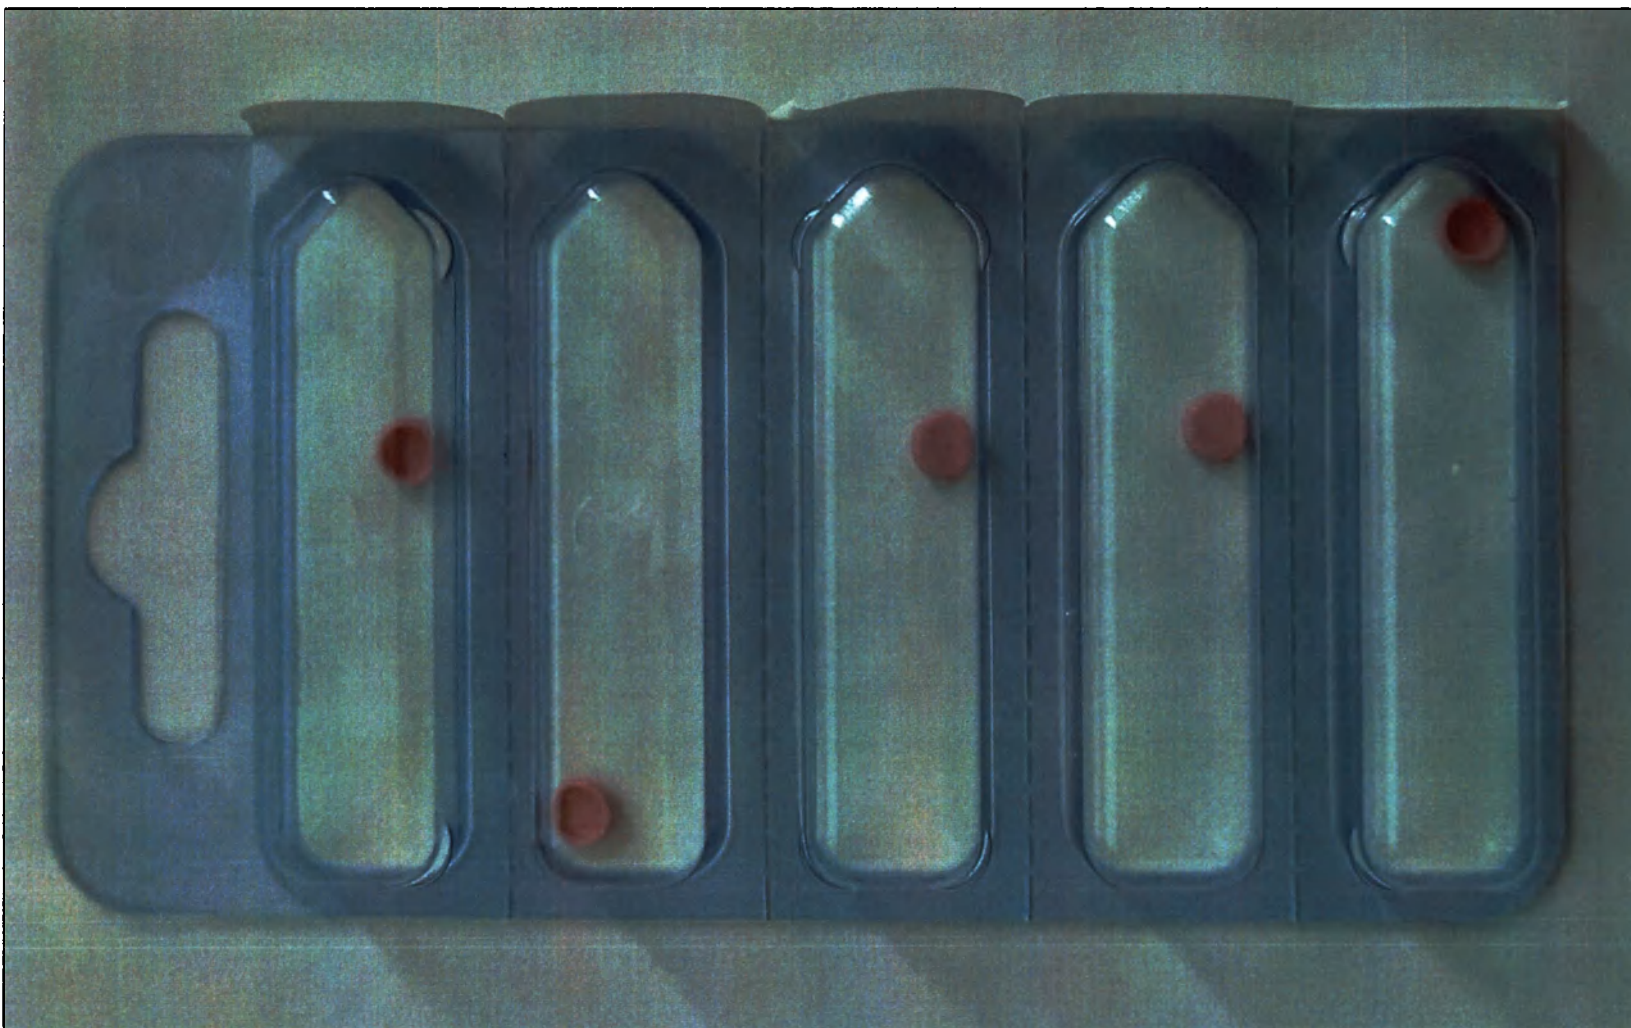

Ретенционная вставка, вариант исполнения: ВСП Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая (изделия в блистере в комплектации)

REF

BCP

LOT

XXX



XX XXXX

Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Ретенционная вставка, вариант исполнения: BCP Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все ретенционные вставки имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Ретенционная вставка, варианты исполнения: BCW Ретенционная вставка, стандартная ретенция, белая
* комплектация всех ретенционных вставок идентичная: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке

REF	BCW	LOT	XXX		XX XXXX
Ретенционная вставка, стандартная ретенция, белая					
Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария					
Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX					
Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Ретенционная вставка, вариант исполнения: BCW Ретенционная вставка, стандартная ретенция, белая

- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все ретенционные вставки имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Ретенционная вставка, варианты исполнения: ВСУ Ретенционная вставка, экстрамягкая ретенция, желтая
* комплектация всех ретенционных вставок идентичная: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке


REF	BCY	LOT	XXX		XX XXXX
Ретенционная вставка, экстрамягкая ретенция, желтая Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Ретенционная вставка, вариант исполнения: BCY Ретенционная вставка, экстрамягкая ретенция, желтая


- * Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке
- * Все ретенционные вставки имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).




НВС Матрица, вариант исполнения: НВС Матрица
* комплектация НВС Матрицы: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке

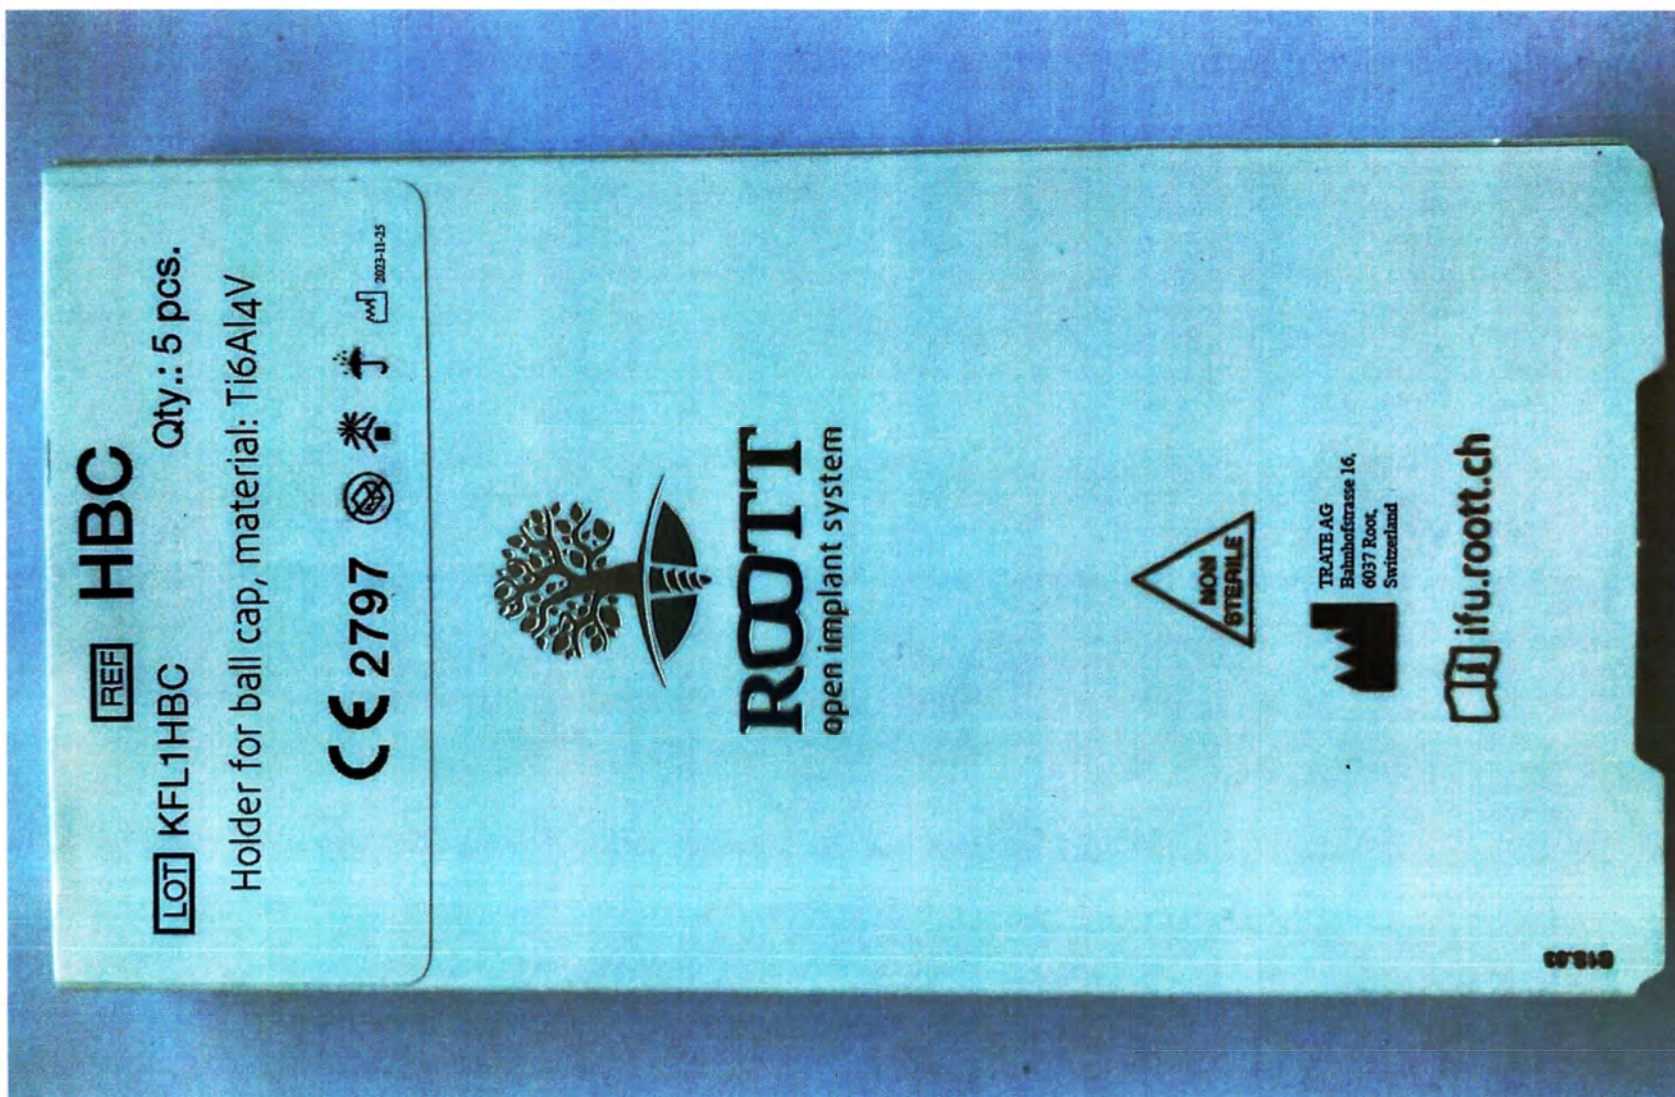

НВС Матрица, вариант исполнения: НВС Матрица (коробка для блистеров)

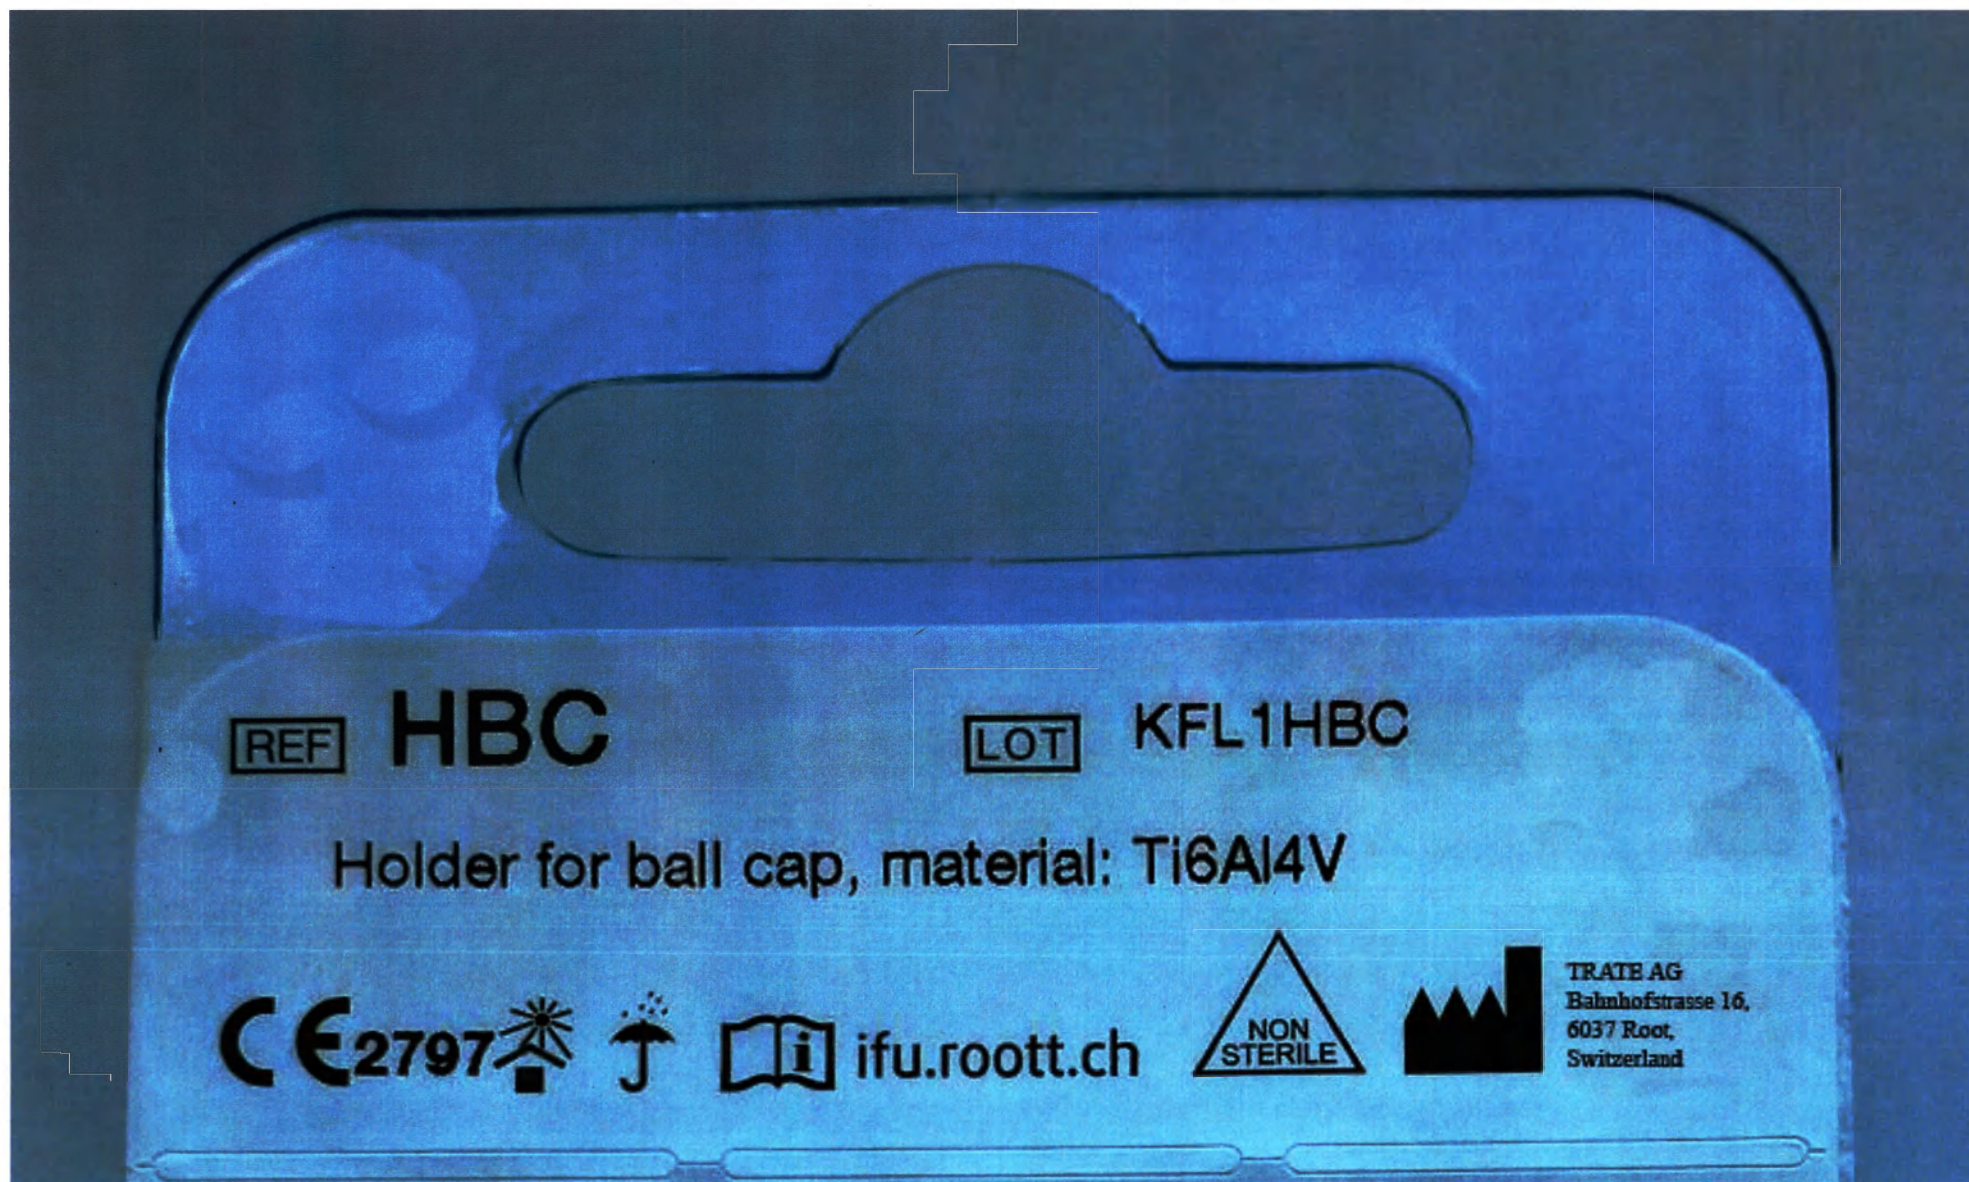

НВС Матрица, вариант исполнения: НВС Матрица (блистер, маркировка)

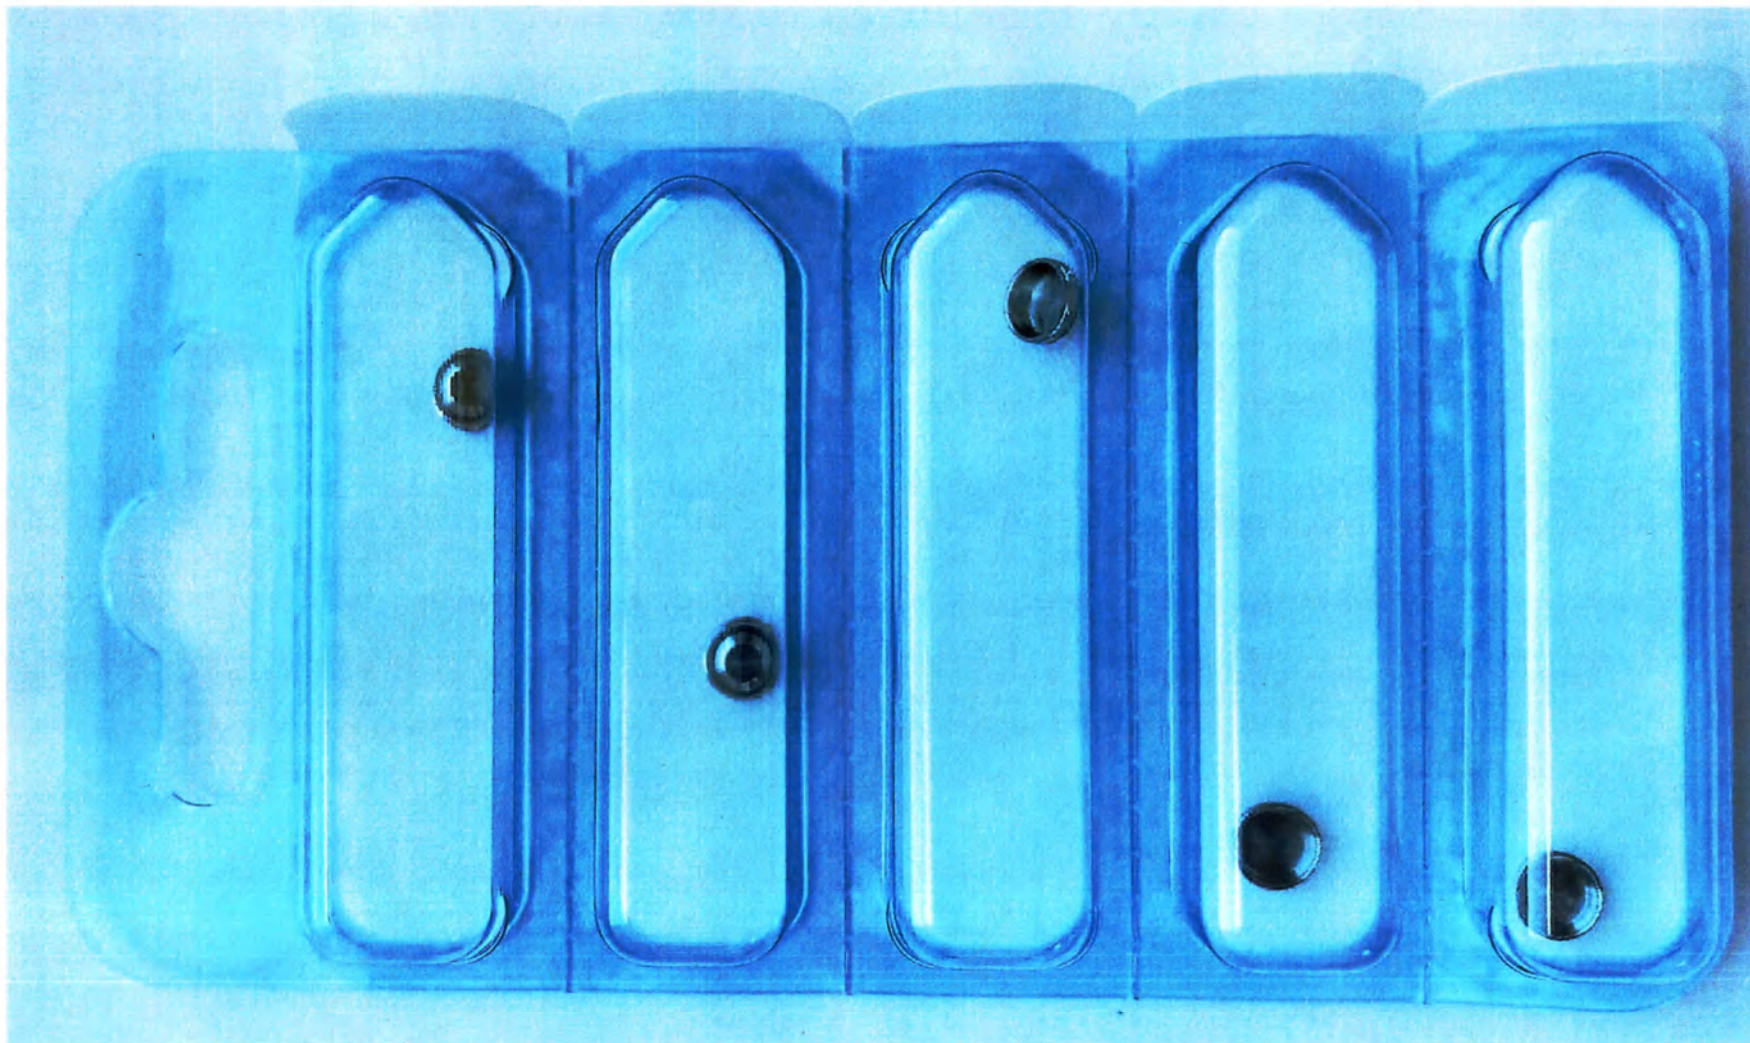

НВС Матрица, вариант исполнения: НВС Матрица (изделия в блистере в комплектации)

REF	НВС	LOT	XXX		XX XXXX
Матрица Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: НВС Матрица, вариант исполнения: НВС Матрица

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке




Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSK Винт ортопедический. К.
*** комплектация всех винтов идентична: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке**




Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSK Винт ортопедический. К. (коробка для блистеров)

* Все винты имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

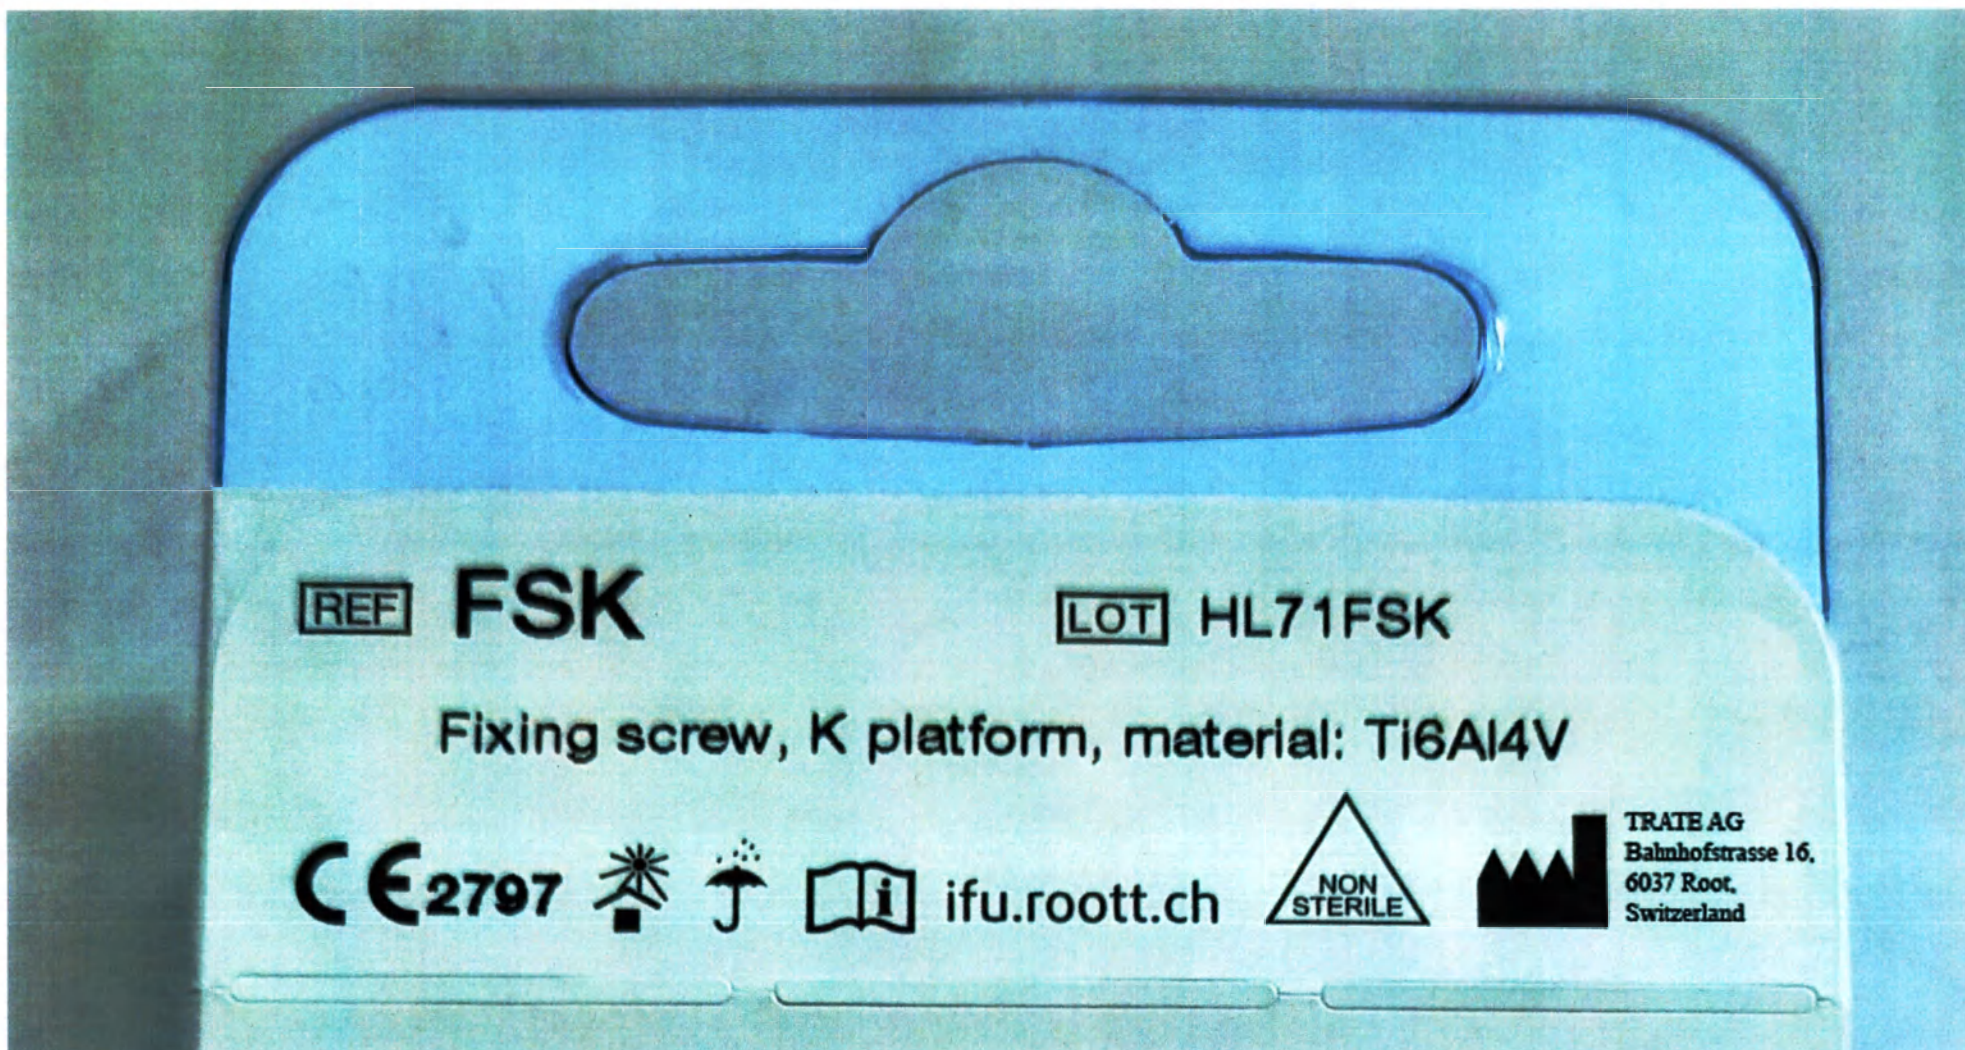

Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSK Винт ортопедический. К. (блистер, маркировка)

* Все винты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

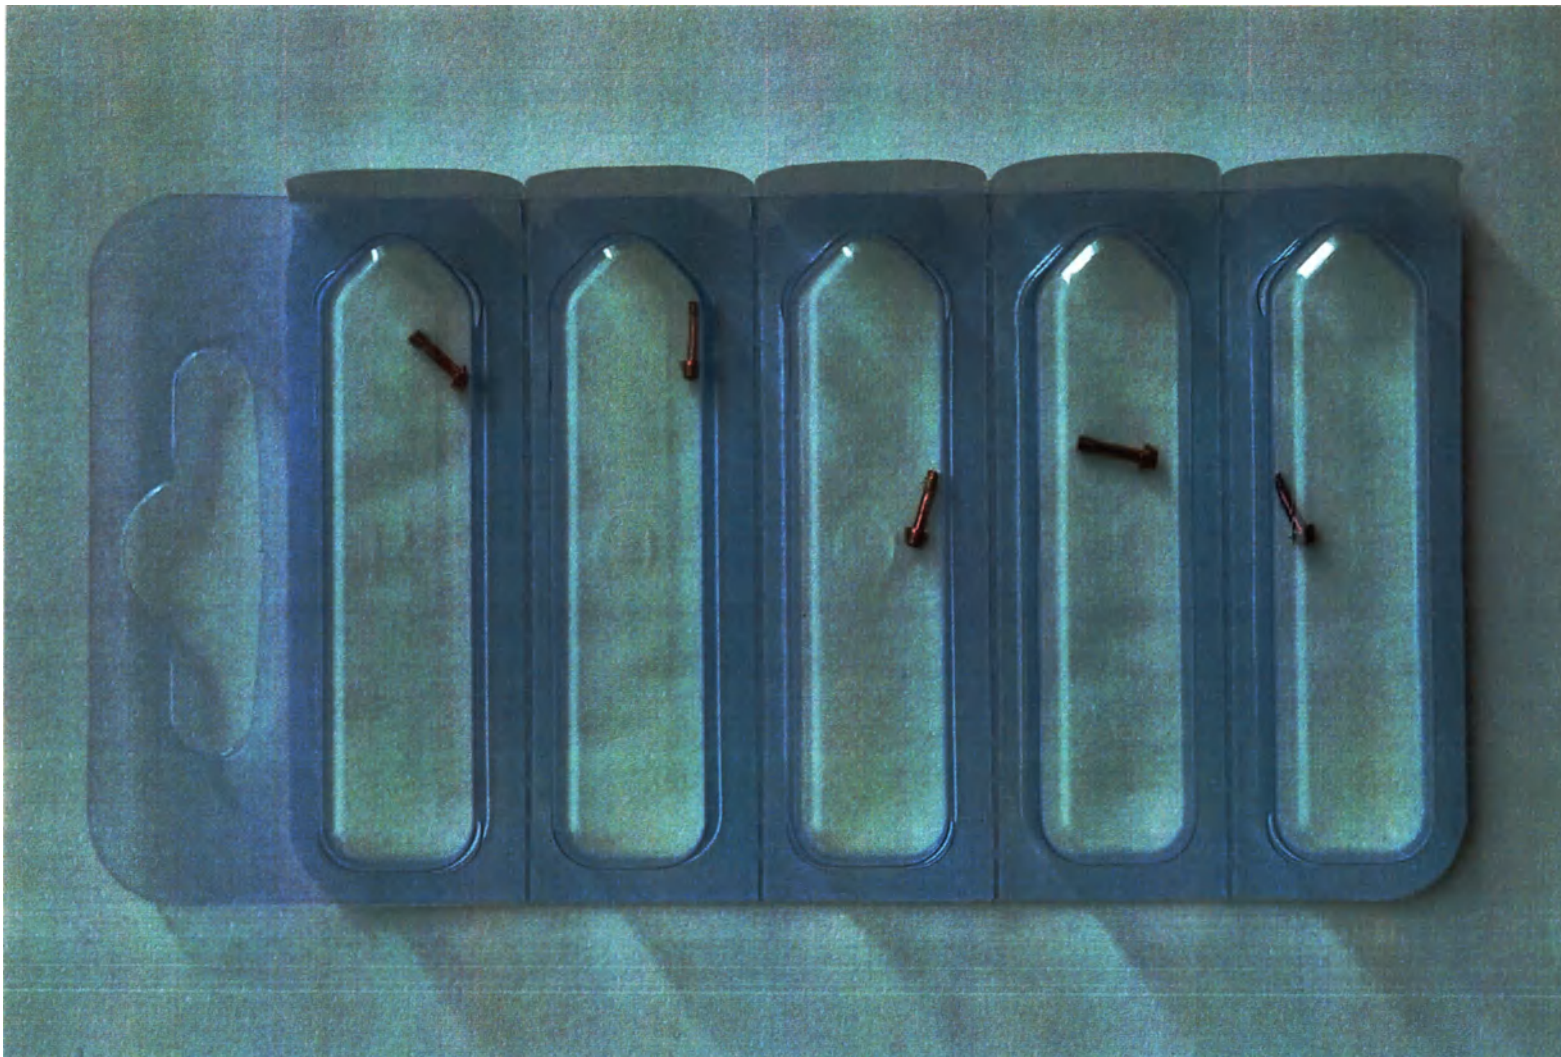

Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSK Винт ортопедический. К. (изделия в блистере в комплектации)

REF

FSK

LOT

XXX



XX XXXX

Винт ортопедический. К**Материал: Ti6Al4V****Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария****Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX****Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать**

Макет этикетки на русском языке: Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSK Винт ортопедический. К.

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все винты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSKL Винт ортопедический. длинный. К.

* комплектация всех винтов идентична: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке

REF

FSKL

LOT

XXX



XX XXXX

Винт ортопедический. длинный. К.

Материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария


Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке: Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: FSKL Винт ортопедический. длинный. К.


*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**

*** Все винты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

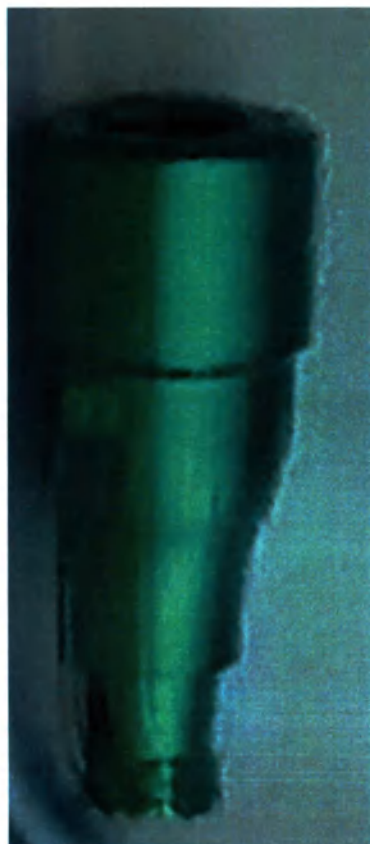

Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: SPCOIOK Скан-абатмент внутриротовой. К.


* комплектация: 1 шт./блистер, комплектуются лабораторным винтом, 5 блистеров в коробке

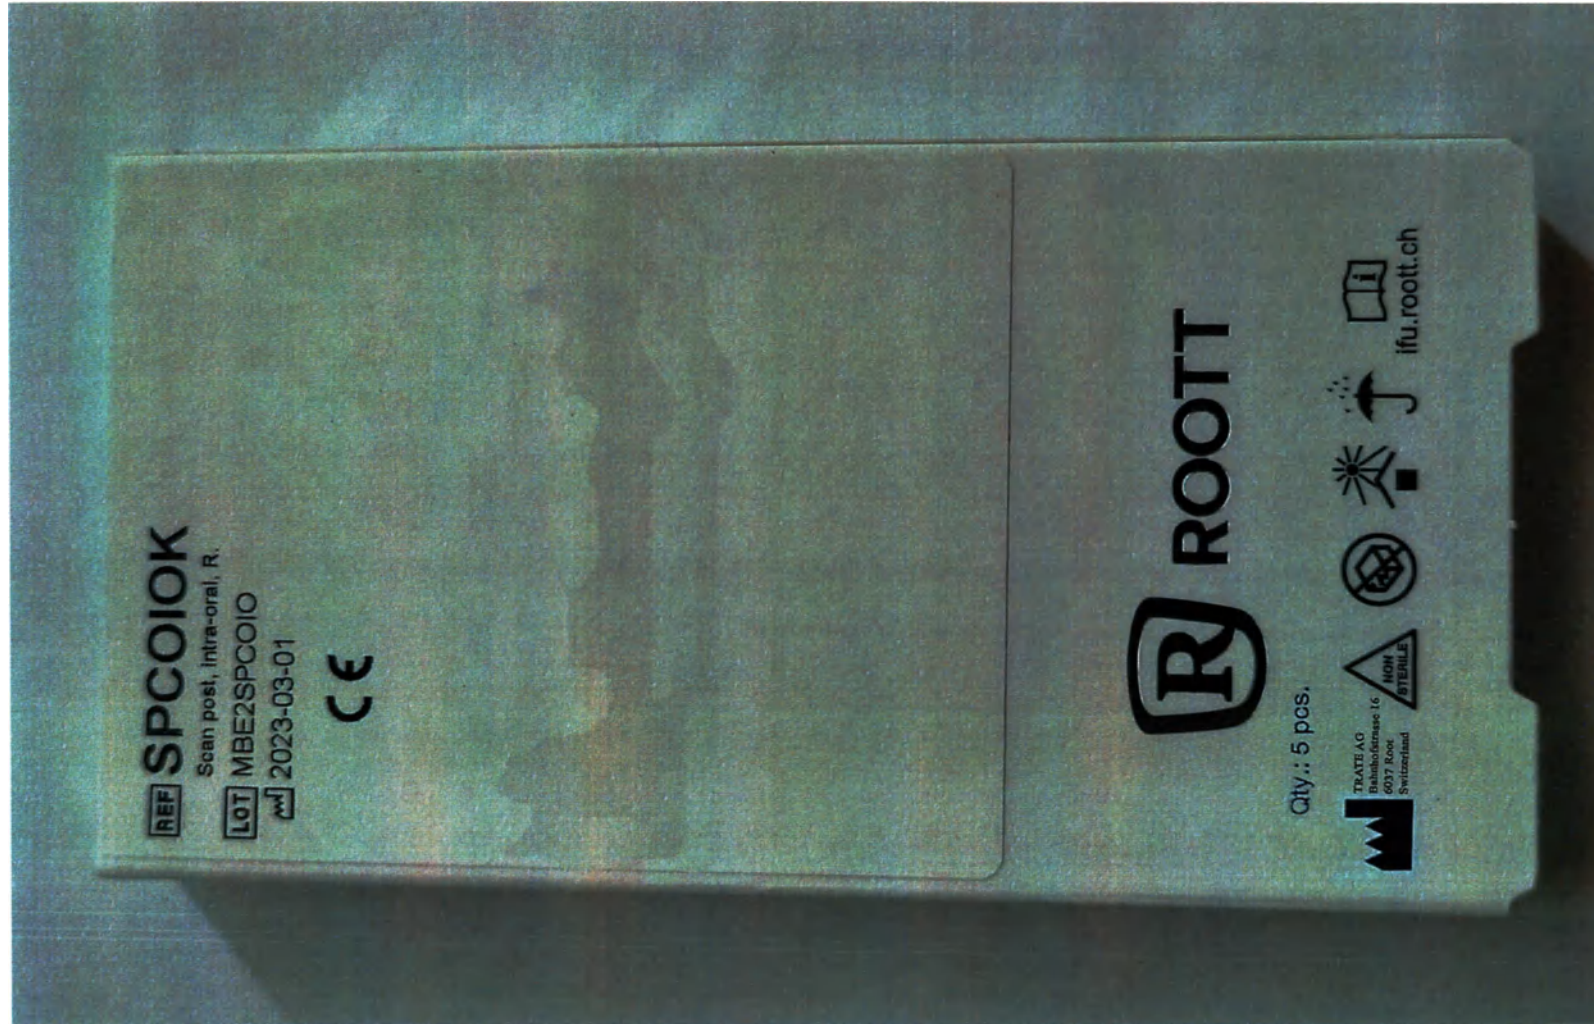

Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: SPCOI0K Скан-абатмент внутриротовой. К. (коробка для блистеров)



Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: SPCOIOK Скан-абатмент внутриротовой. К. (блистер, маркировка)

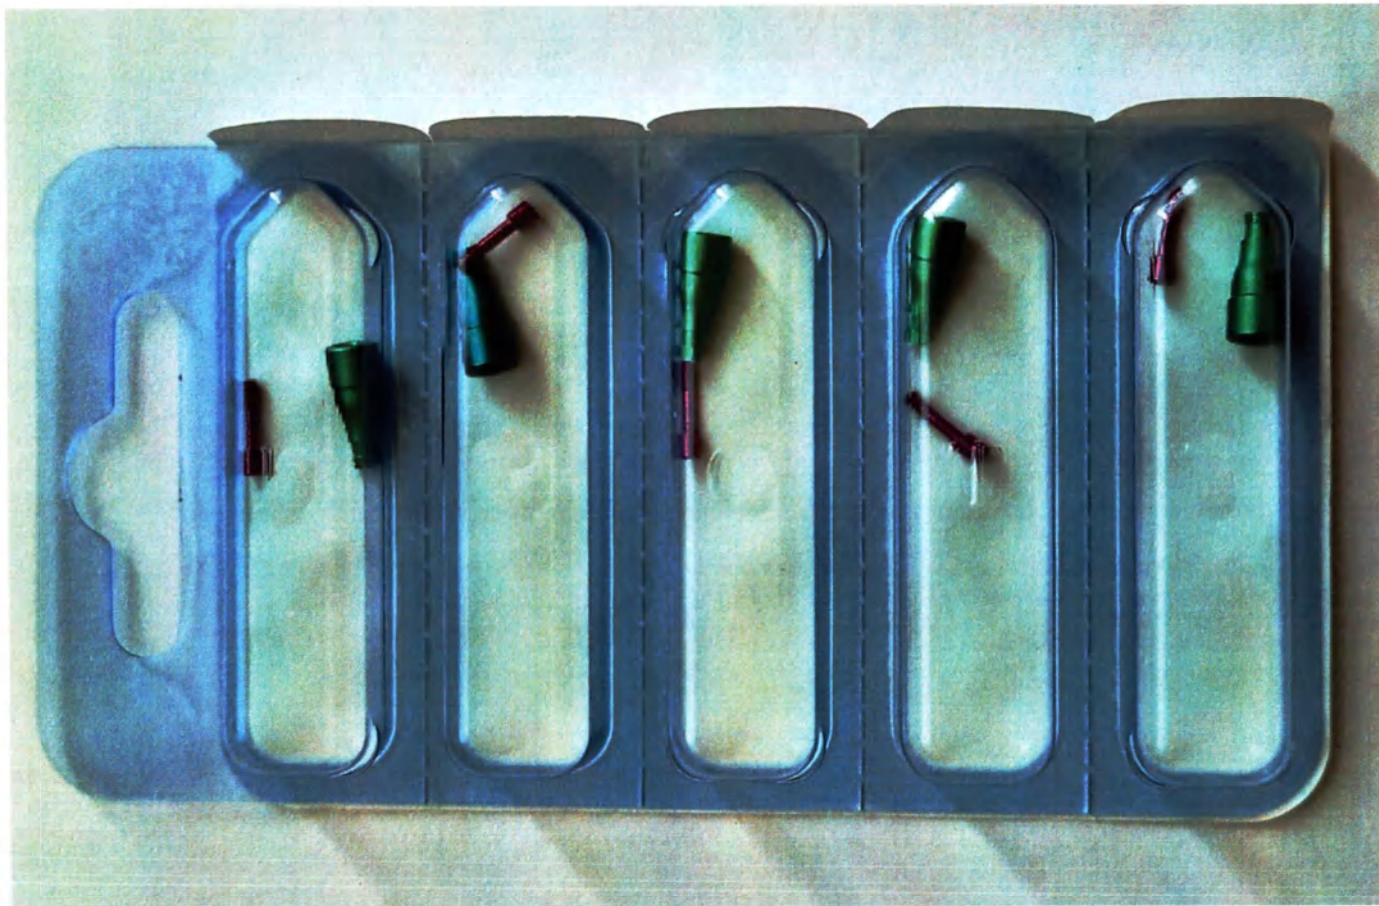

Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: SPCOIOK Скан-абатмент внутриротовой. К. (изделия в блистере в комплектации)

REF

SPCOIOK

LOT

XXX



XX XXXX

SPCOIOK Скан-абатмент внутриротовой. К**материал: Ti6Al4V****Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария****Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX****Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать**


Макет этикетки на русском языке: Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: SPCOIOK Скан-абатмент внутриротовой. К.

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке




Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: TTCK Абатмент временный. стандартный; TTCKS Абатмент временный. короткий. К; TTCKXS Абатмент временный. экстра короткий. К.

*** внешний вид всех абатментов временных и их комплектация идентичны: 1 шт./блистер, комплектуются лабораторным винтом, 5 блистеров в коробке**

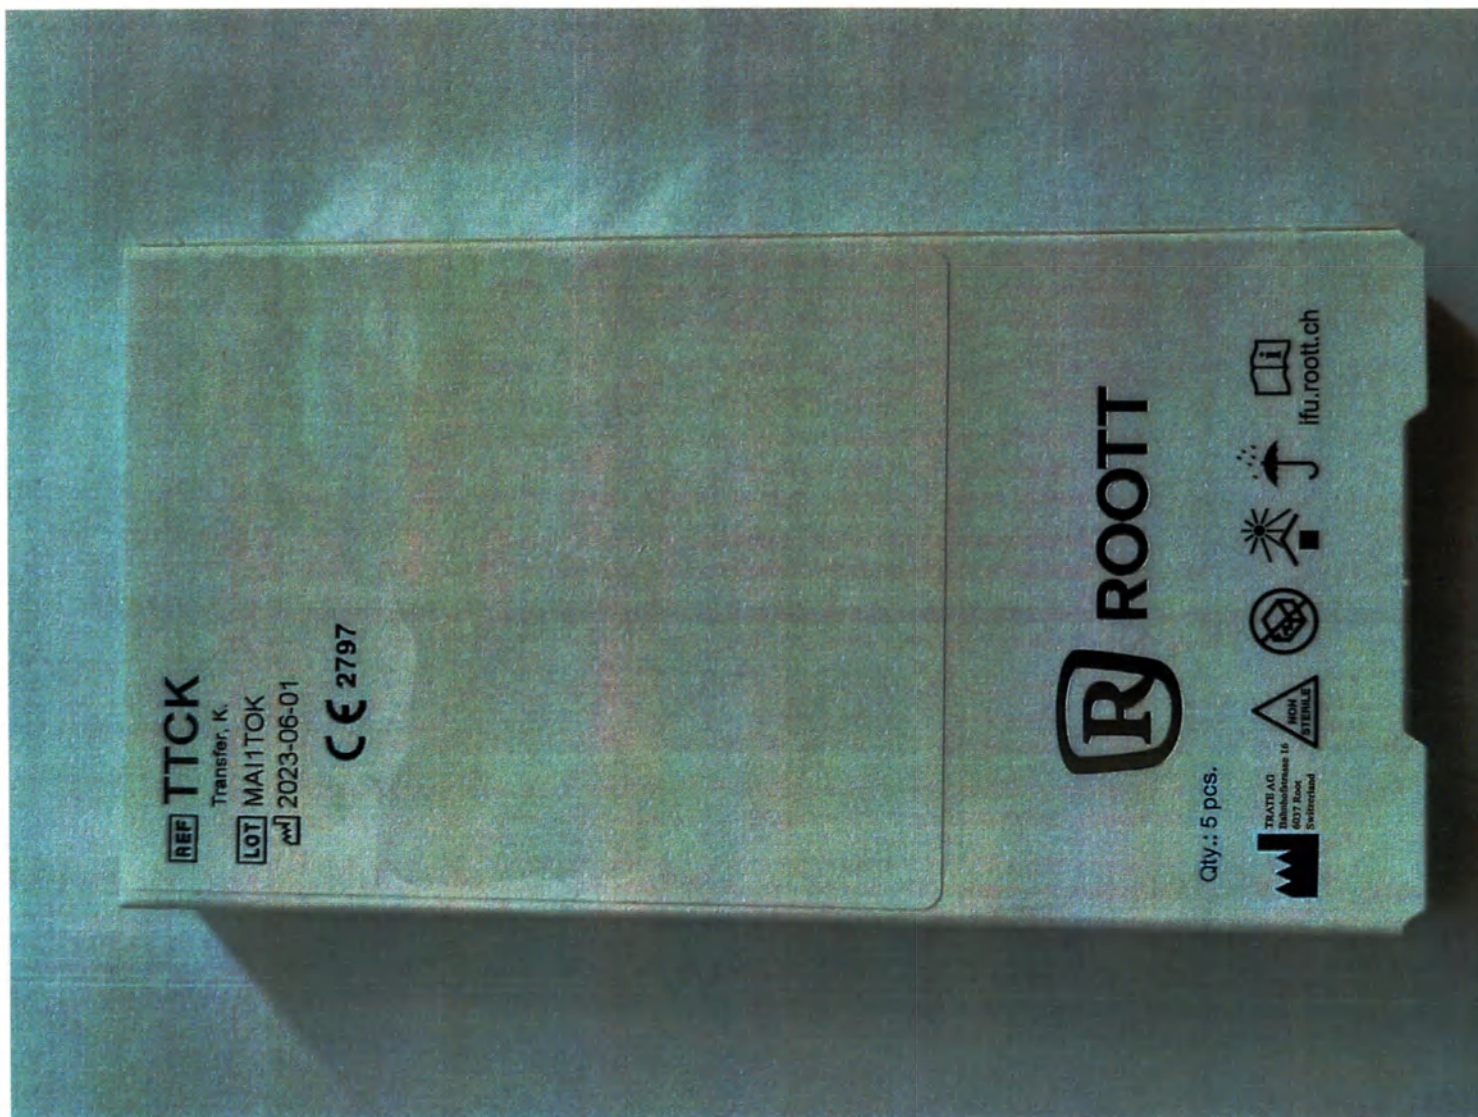

Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: TTCK Абатмент временный. стандартный (коробка для блистеров)

*Все Абатменты временные имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

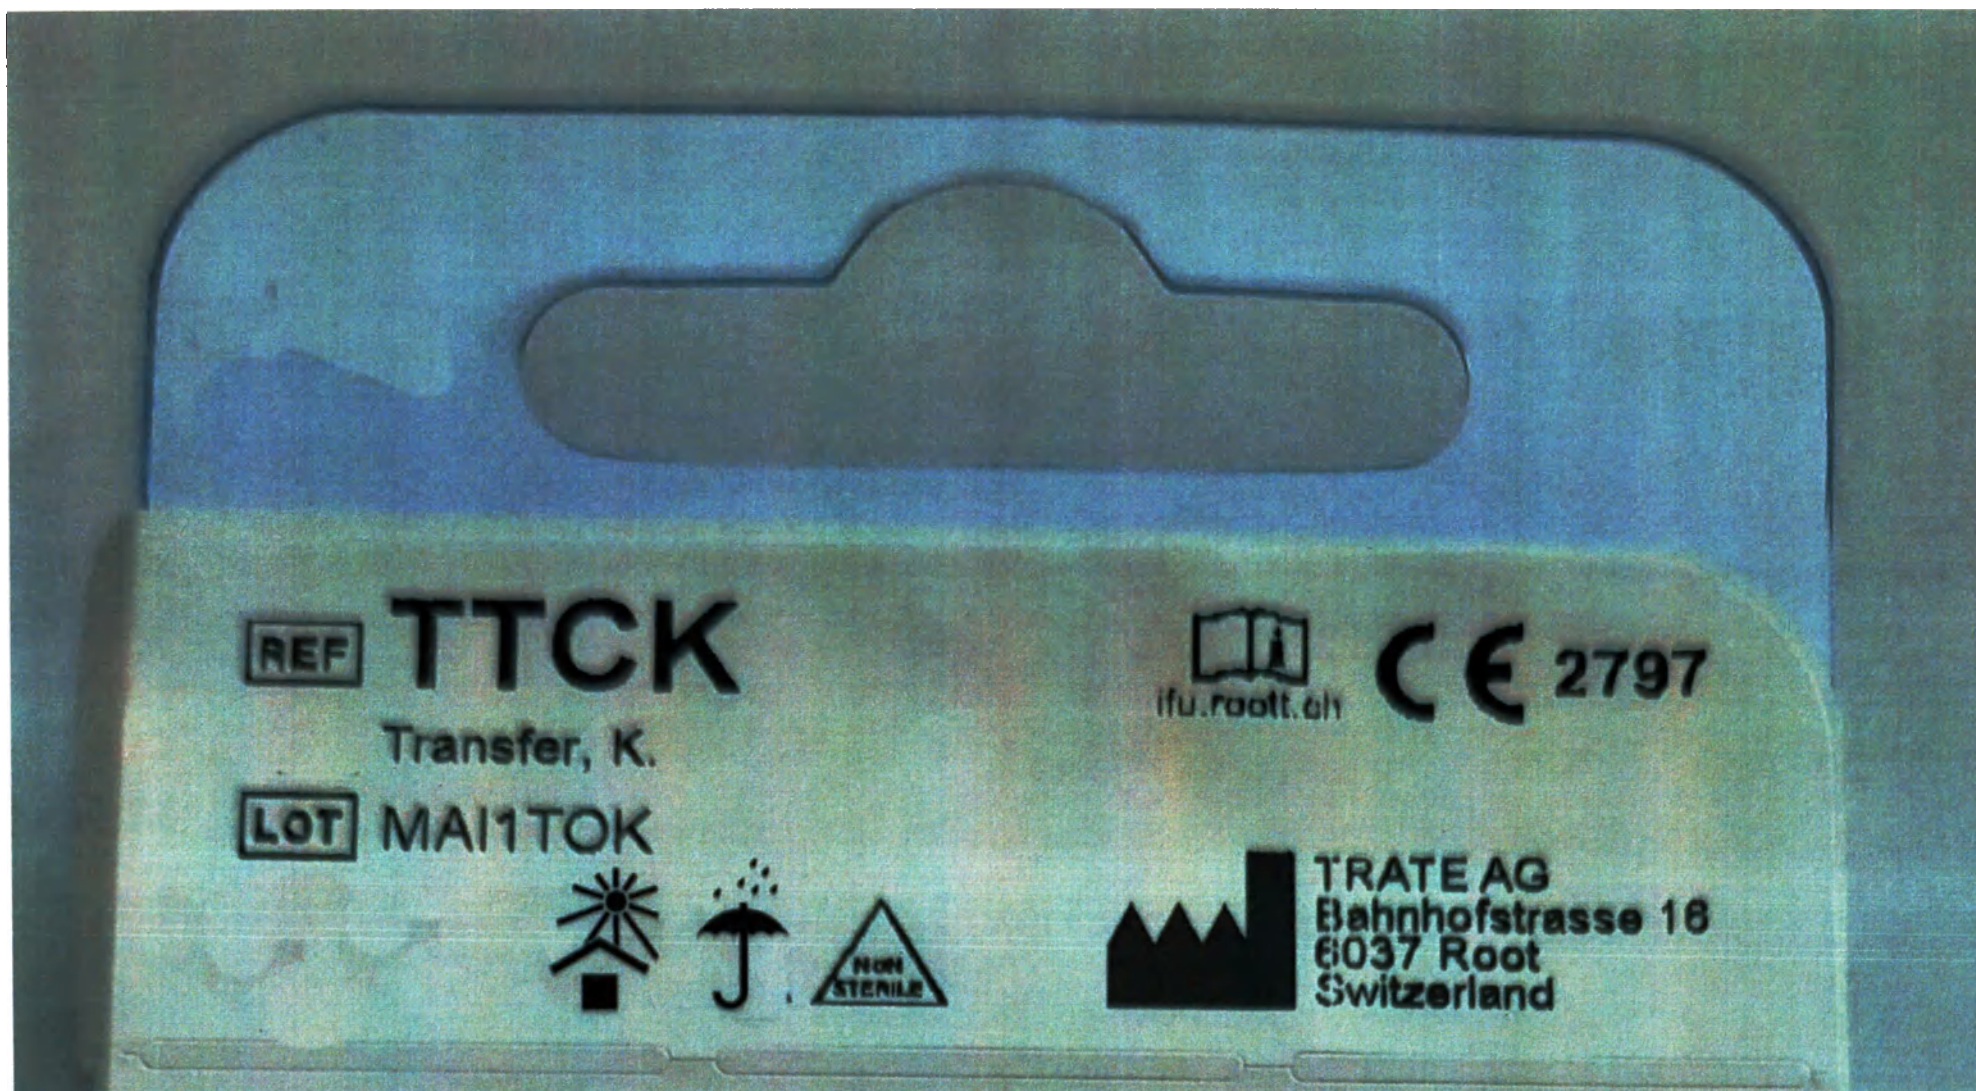

Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: A05K Абатмент односоставной, H 0.5 мм (блистер, маркировка).

*Все односоставные абатменты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).



Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: ТТСК Абатмент временный. стандартный (изделия в блистере в комплектации).

REF	TTCK	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент временный. стандартный материал: Ti6Al4V Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: TTCK Абатмент временный. стандартный

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все абатменты временные имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

REF	TTCKS	LOT	XXX		XX XXXX
Абатмент временный. короткий. К материал: Ti6Al4V Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать					

Макет этикетки на русском языке: Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: TTCKS Абатмент временный. короткий. К

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

*Все абатменты временные имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

REF

TTCKXS

LOT

XXX



XX XXXX

Абатмент временный. экстра короткий. К

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария


Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

**Макет этикетки на русском языке: Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
TTCKXS Абатмент временный. экстра короткий. К**


*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**

***Все абатменты временные имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

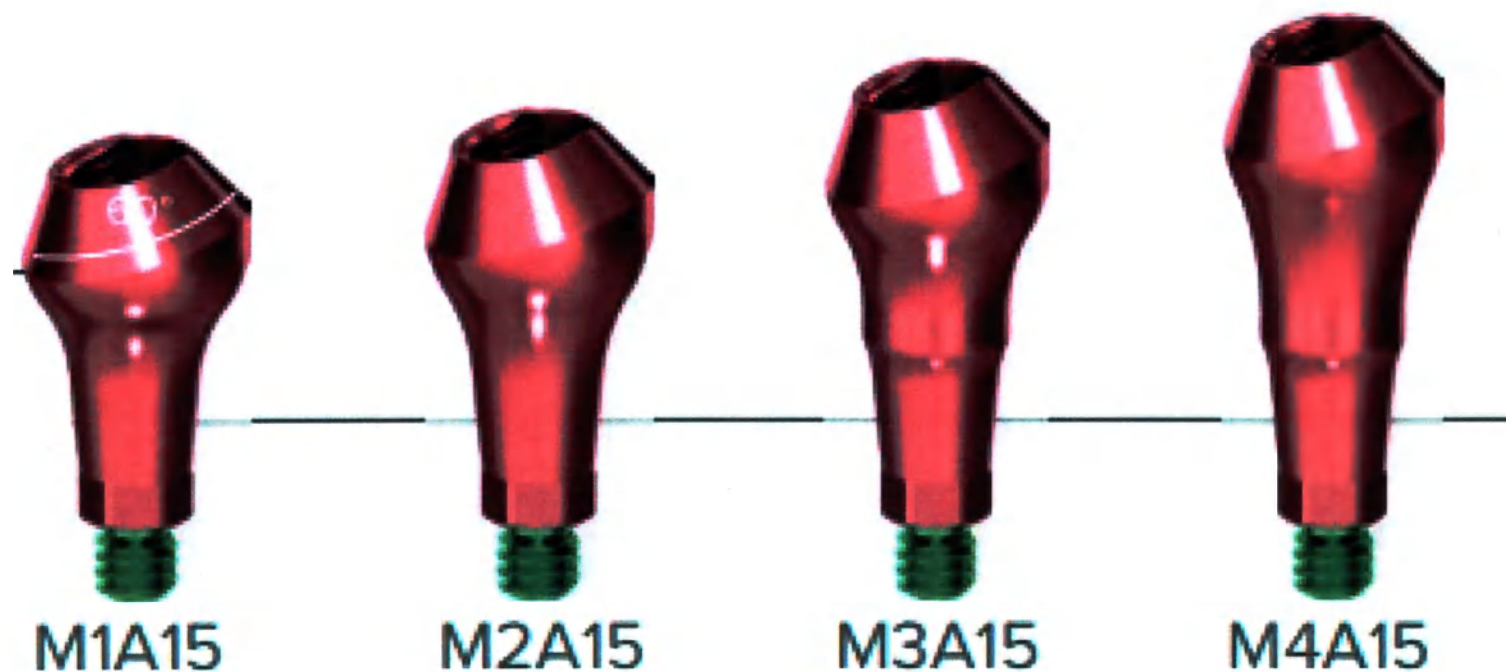


Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: M1A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 1 мм., M2A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 2 мм., M3A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 3 мм., M4A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 4 мм.

* комплектация всех мультиюнит абатментов идентичная: 1 шт./блистер, комплектуются винтом для мультиюнит абатмента и лабораторным винтом для мультиюнит абатмента, 5 блистеров в коробке

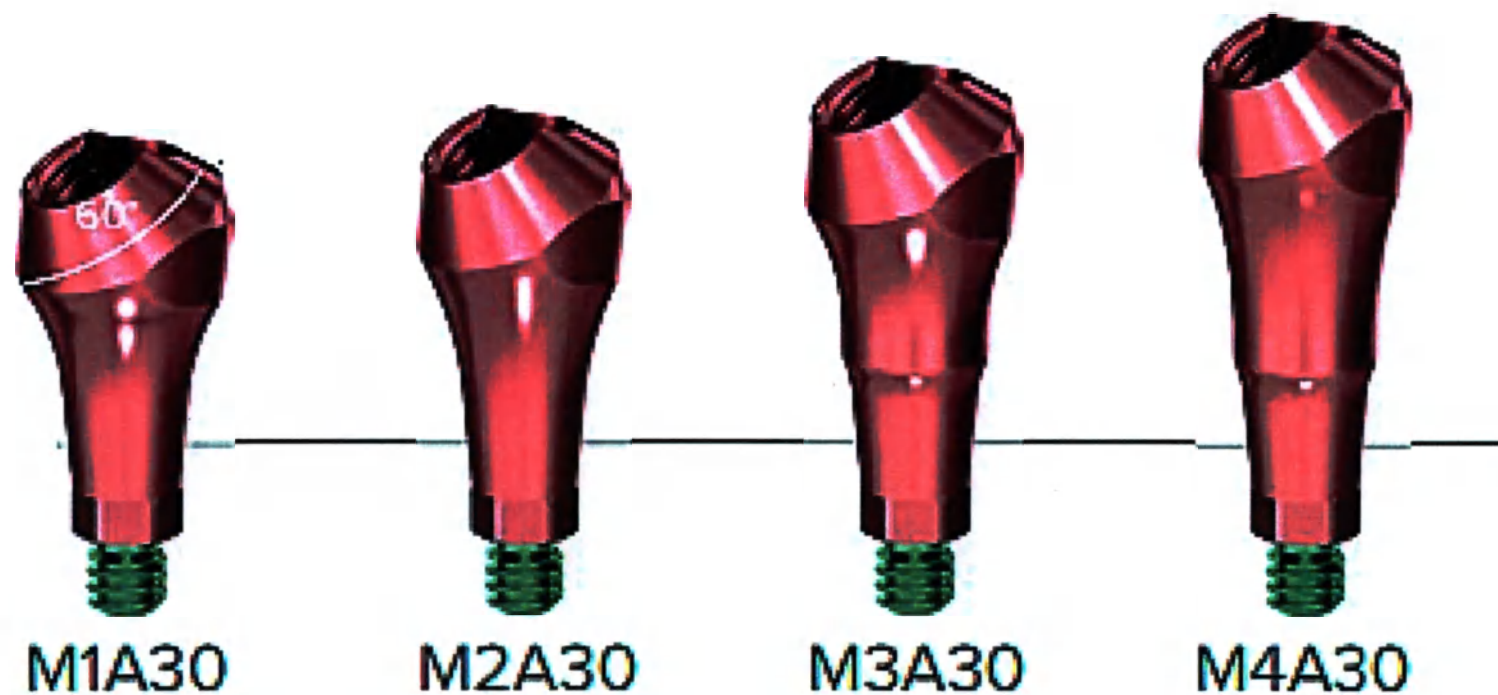


Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм., M2A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 2 мм., M3A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 3 мм., M4A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 4 мм.

* комплектация всех мультиюнит абатментов идентичная: 1 шт./блистер, комплектуются винтом для мультиюнит абатмента и лабораторным винтом для мультиюнит абатмента, 5 блистеров в коробке

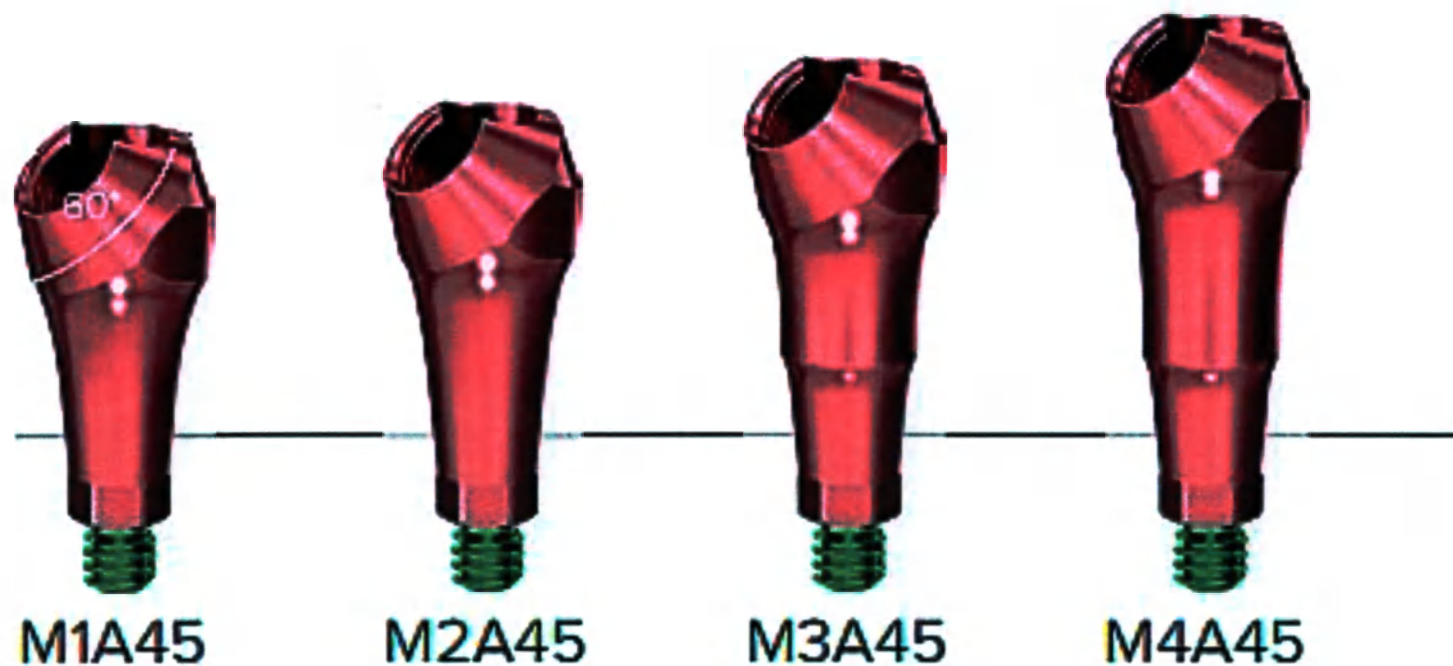


Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения: M1A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 1 мм., M2A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 2 мм., M3A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 3 мм., M4A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 4 мм.

* комплектация всех мультиюнит абатментов идентичная: 1 шт./блистер, комплектуются винтом для мультиюнит абатмента и лабораторным винтом для мультиюнит абатмента, 5 блистеров в коробке

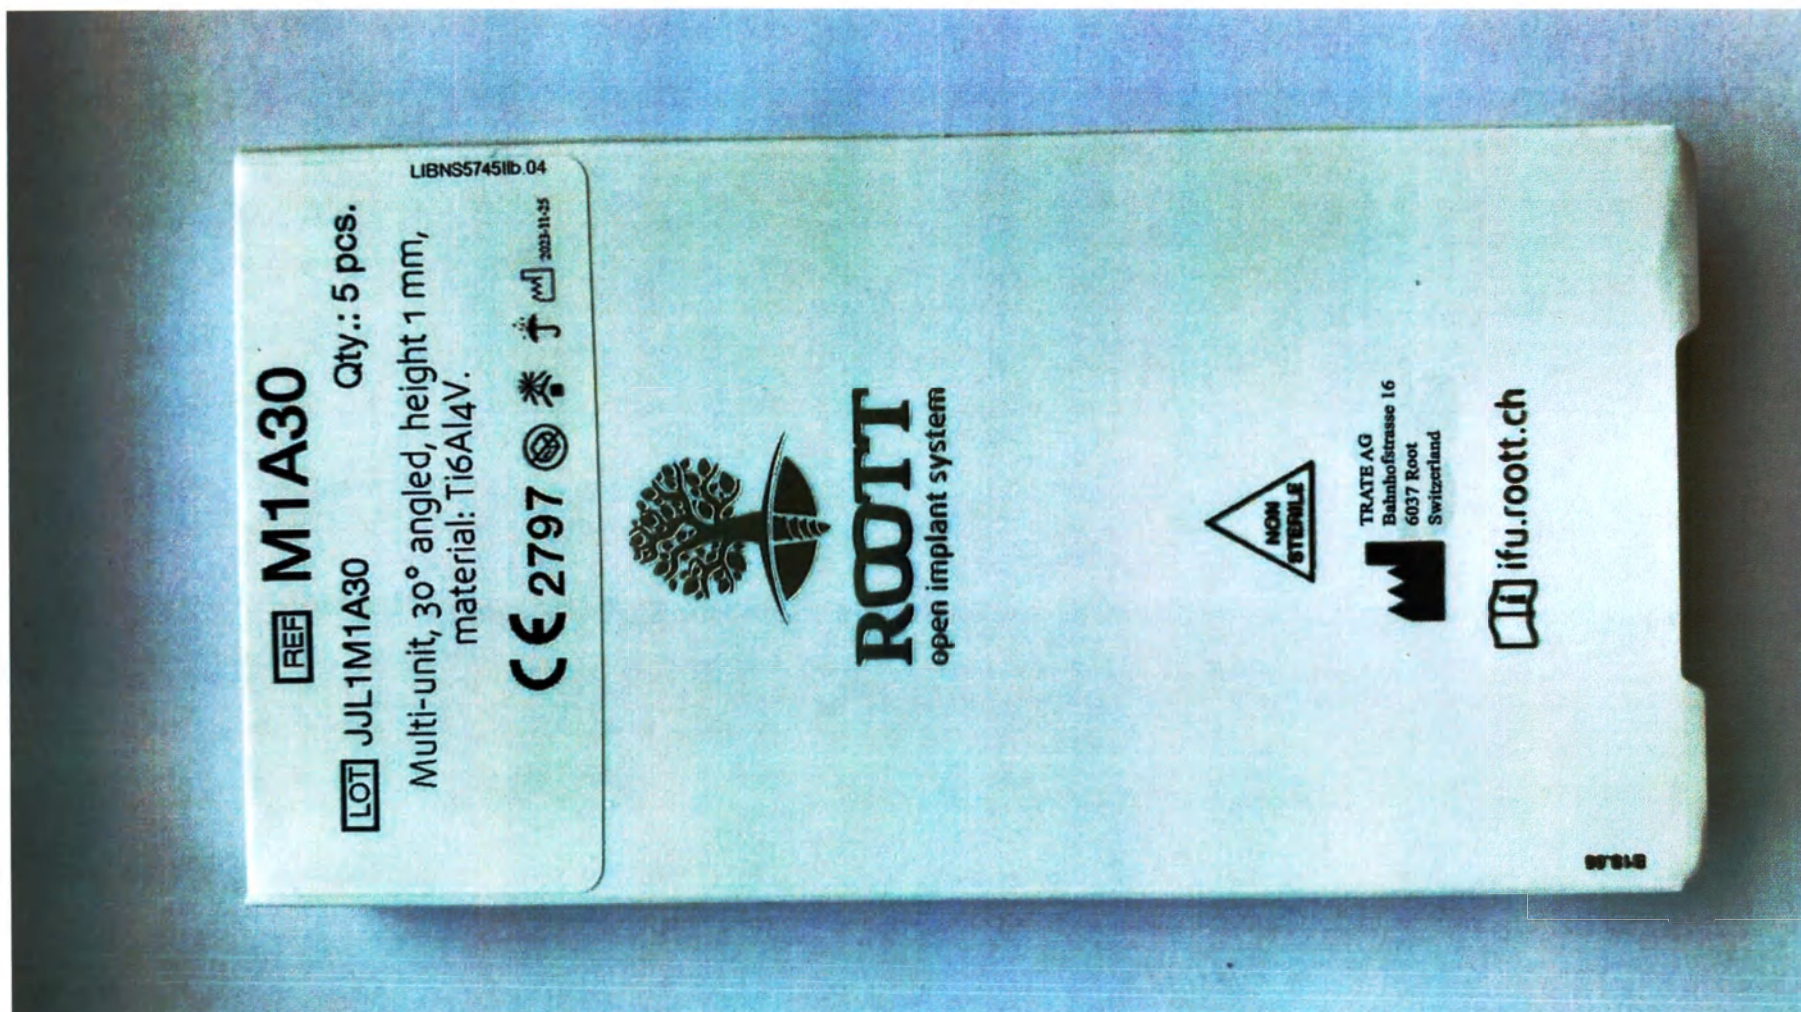


Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм. (коробка для блистеров)

*Все мультиюнит абатменты имеют идентичную коробку с блистерами и ее маркировку. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

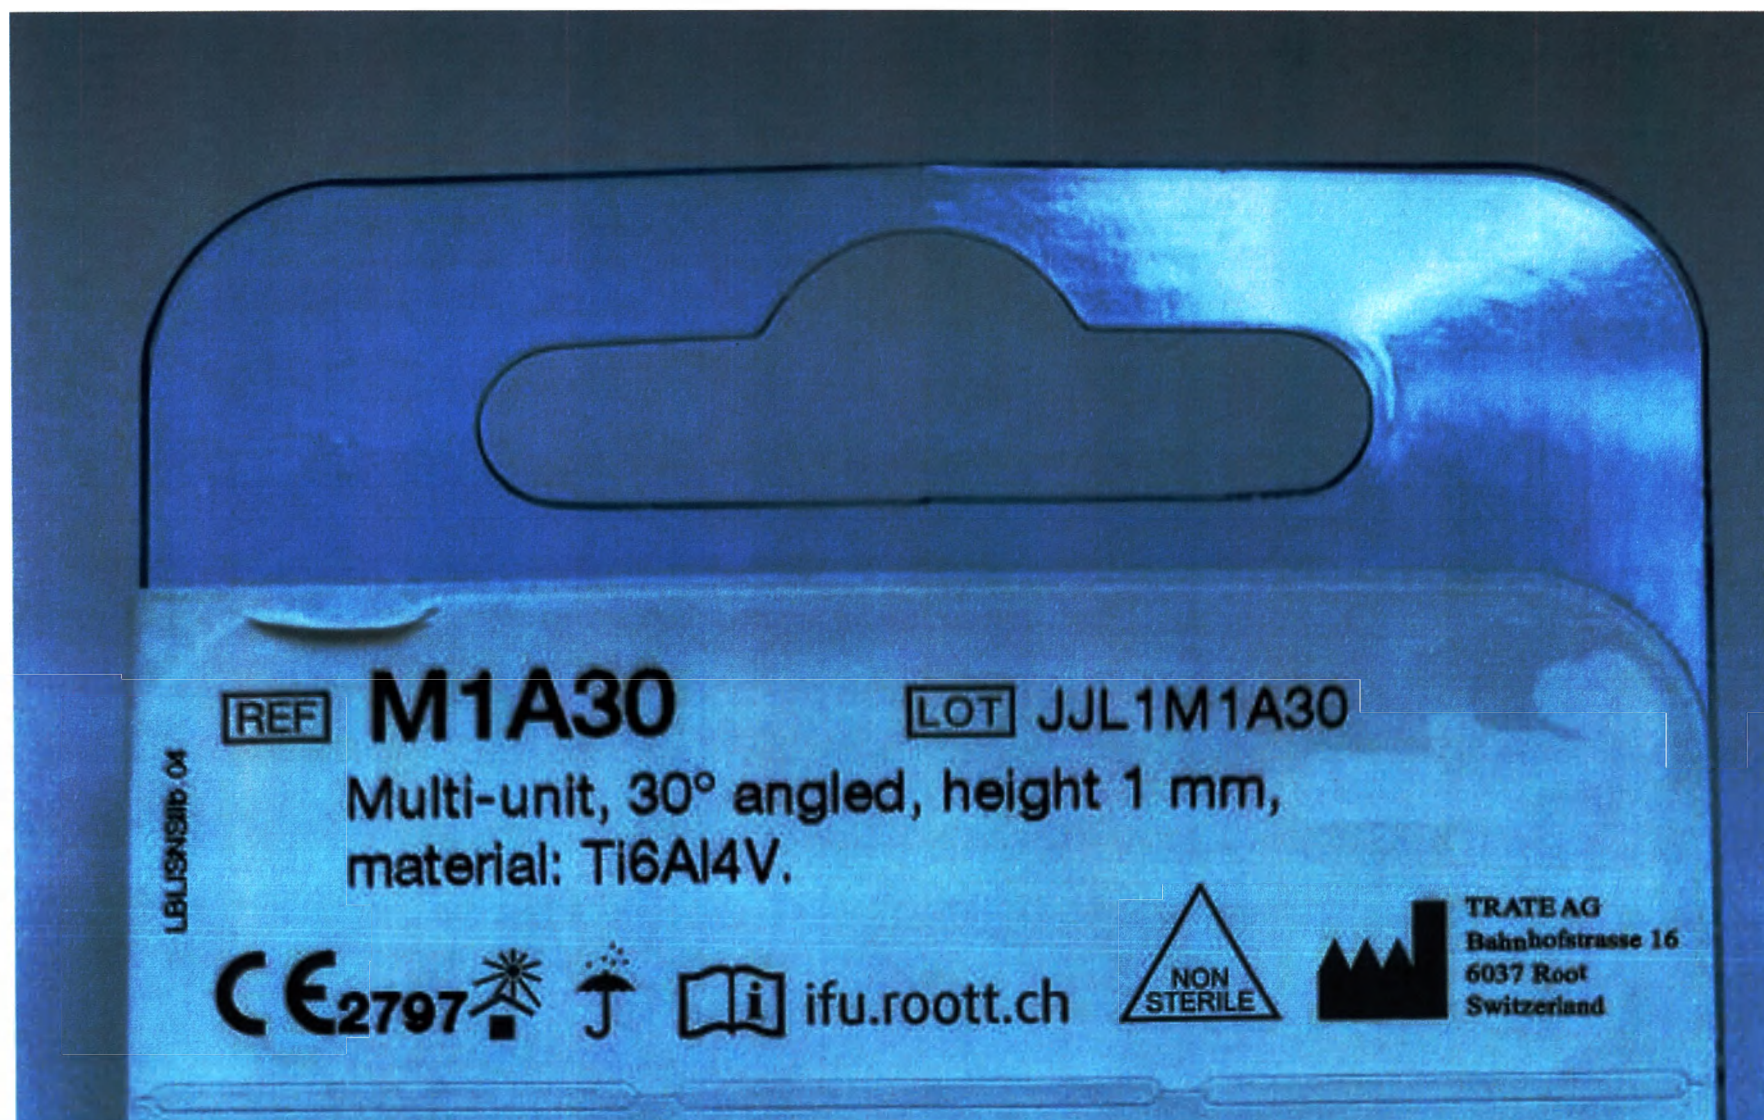

Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм. (блистер, маркировка).

*Все мультиюнит абатменты имеют идентичную маркировку блистера. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

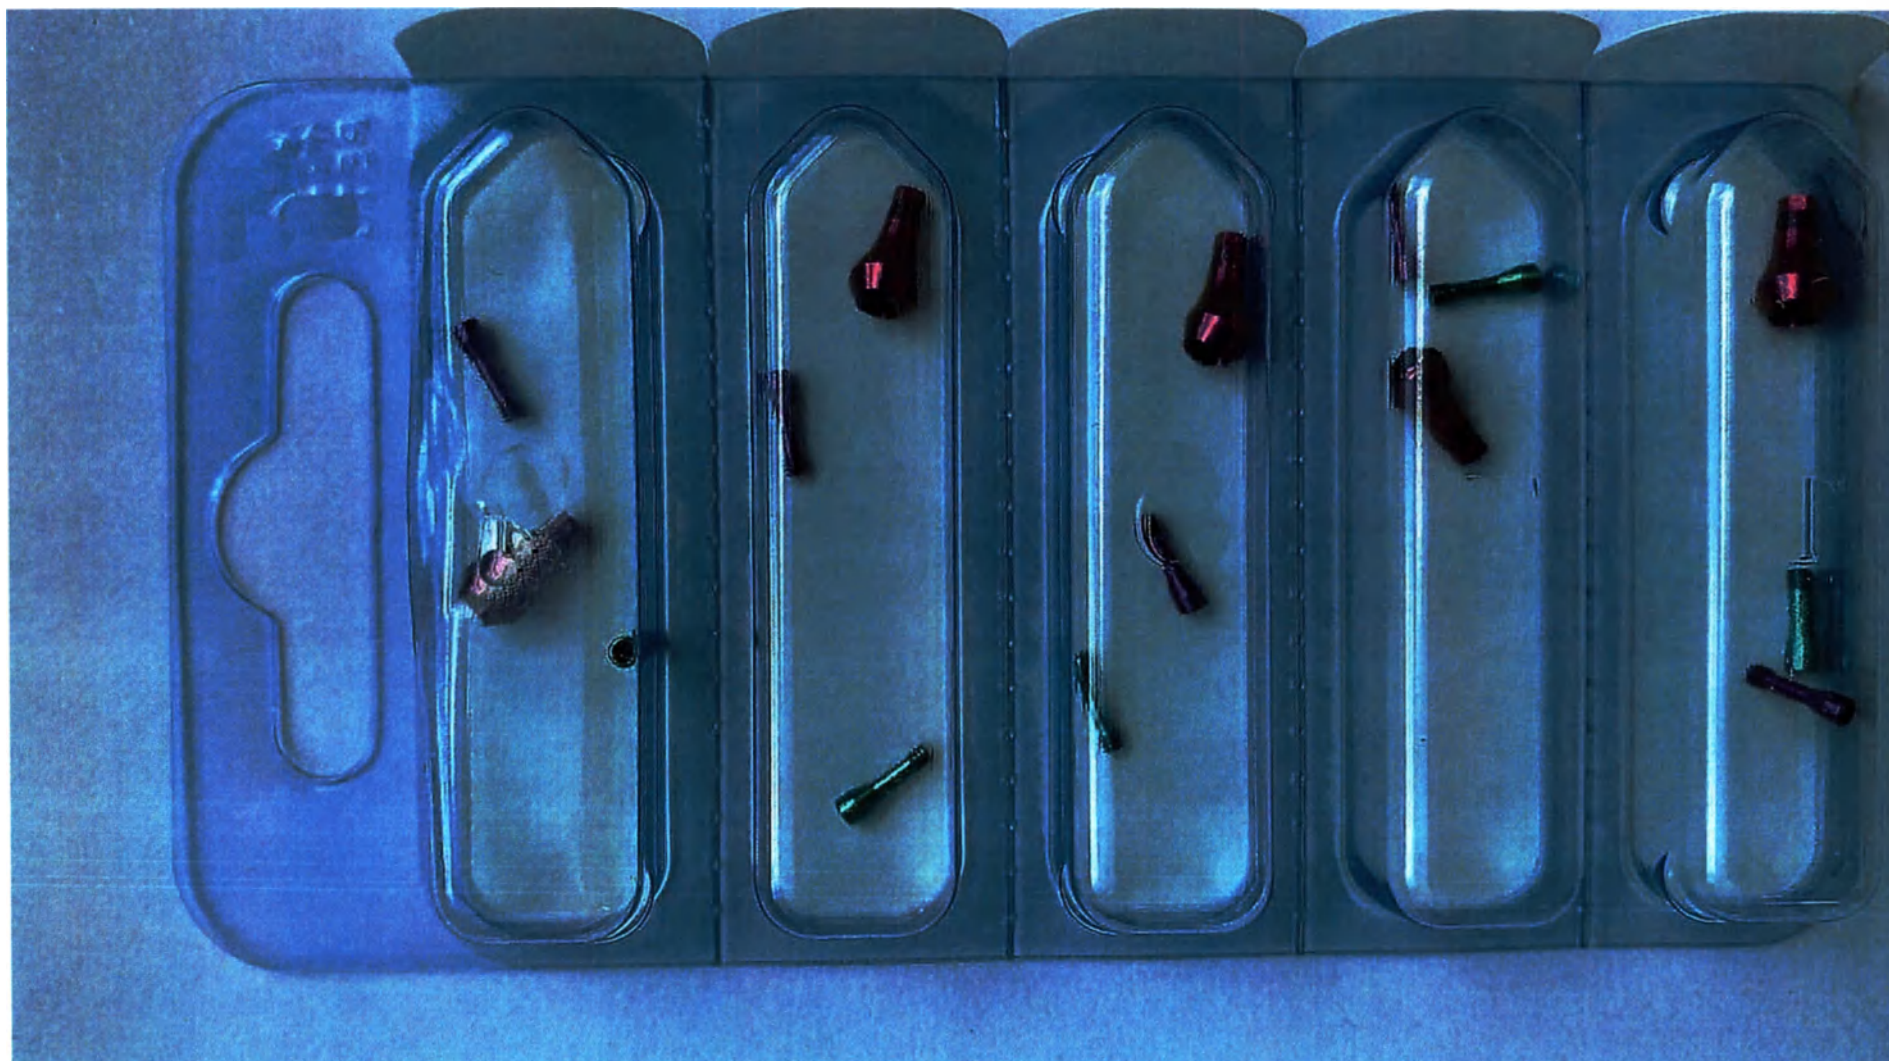

Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм. (изделия в блистере в комплектации).

REF M1A30 **LOT** XXX  XX XXXX

Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм.

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

**Макет этикетки на русском языке: Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм.**

*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**

*** Все мультиюнит абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**

REF

M1A15

LOT

XXX



XX XXXX

Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 1 мм.

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

**Макет этикетки на русском языке: Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
M1A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 1 мм.**

* Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке

* Все мультиюнит абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).

REF**M1A45****LOT****XXX****XX XXXX**

Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 1 мм

материал: Ti6Al4V

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать


**Макет этикетки на русском языке: Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
M1A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 1 мм.**

*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**


*** Все мультиюнит абатменты имеют идентичную маркировку на русском языке. Разница заключается только в наименовании, REF, LOT изделия и дате производства (где применимо).**




**Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К.
* комплектация: 1 шт./блистер, 5 блистеров в коробке**

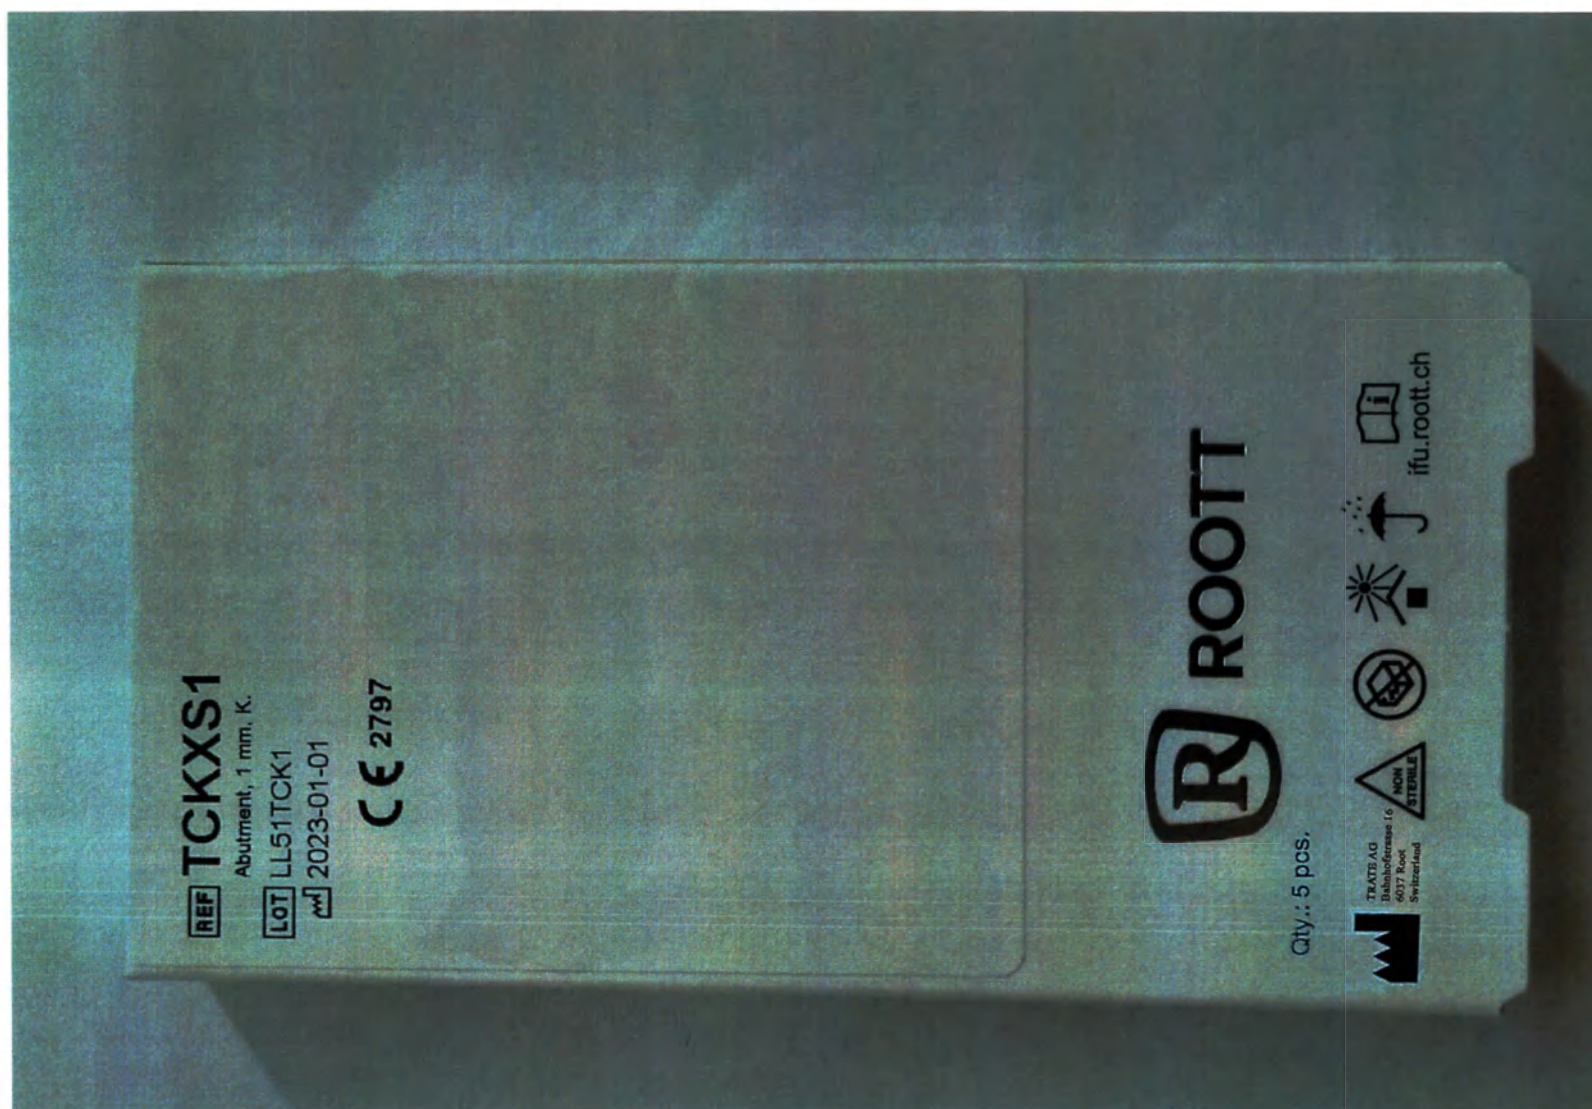

Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К. (коробка для блистеров)

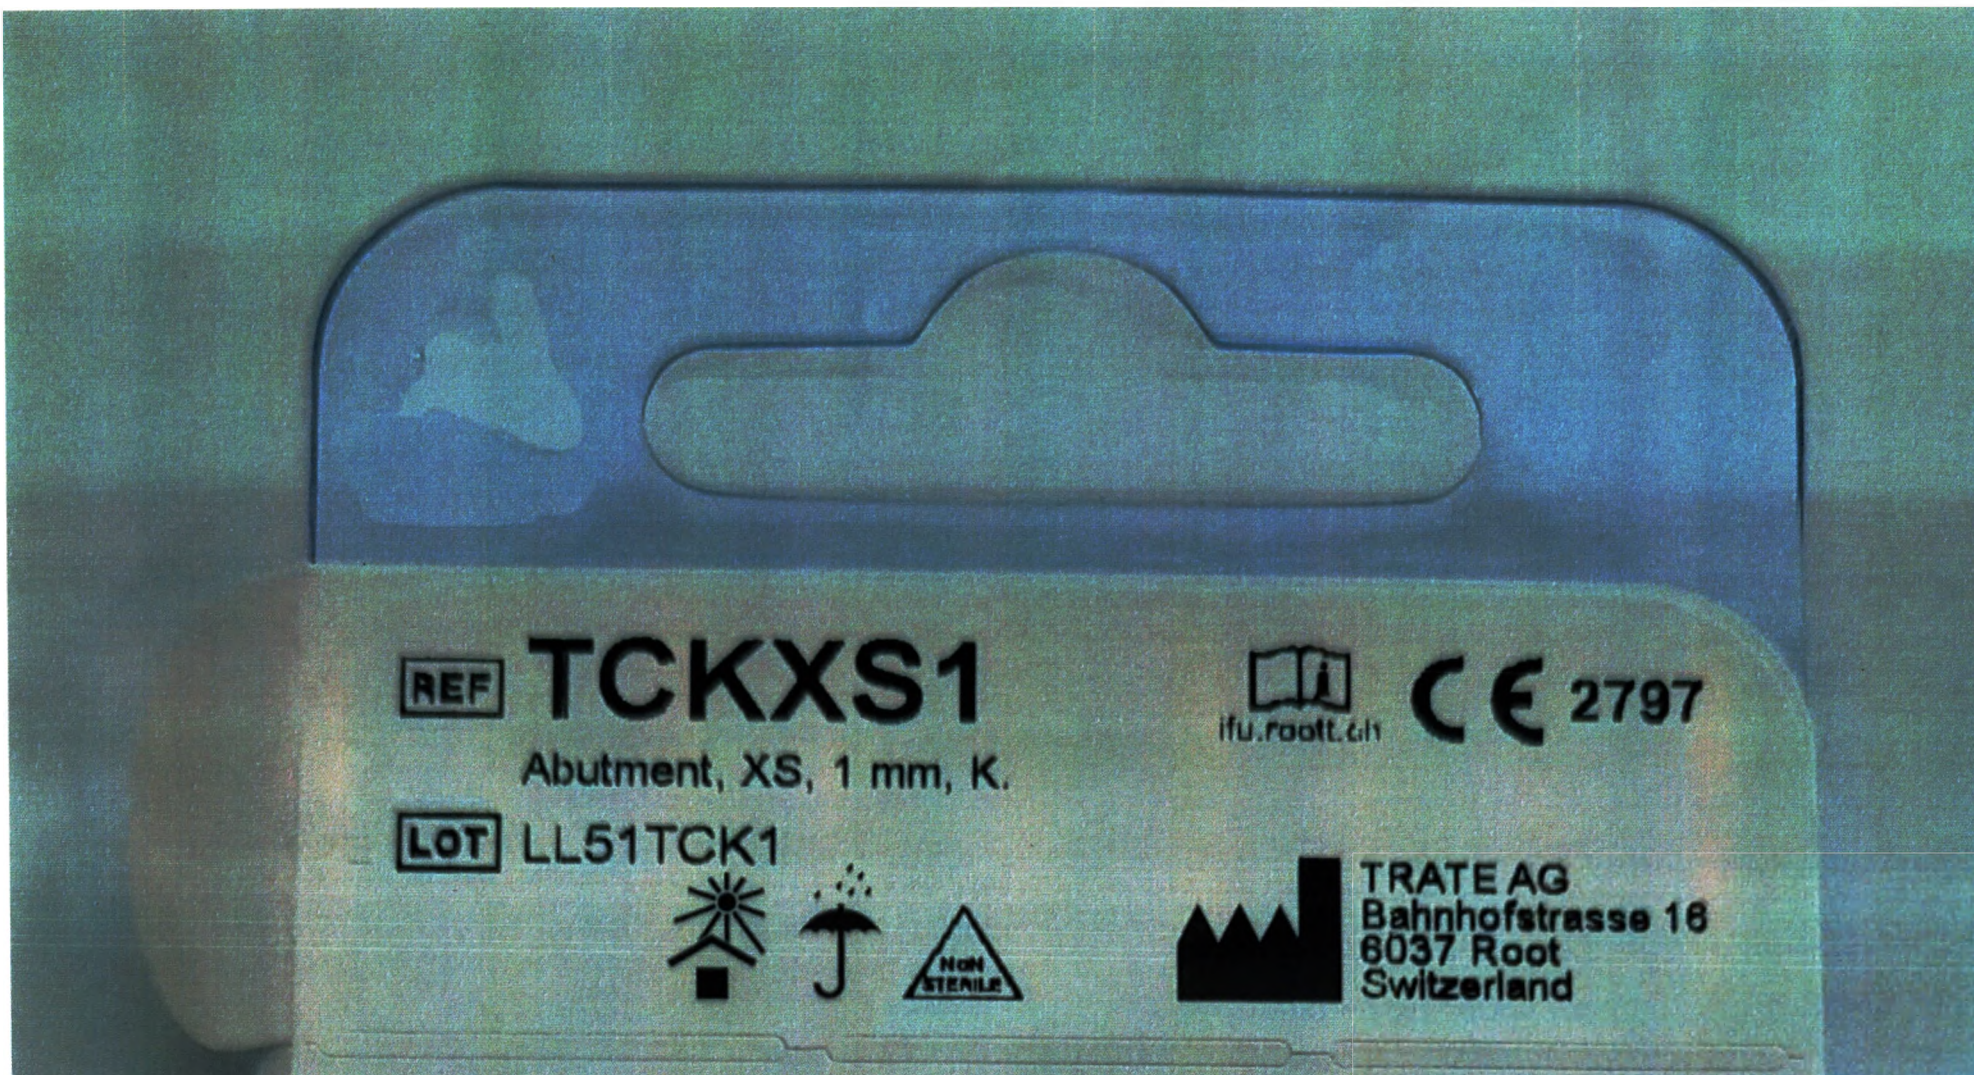

Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения: TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К. (блистер, маркировка)

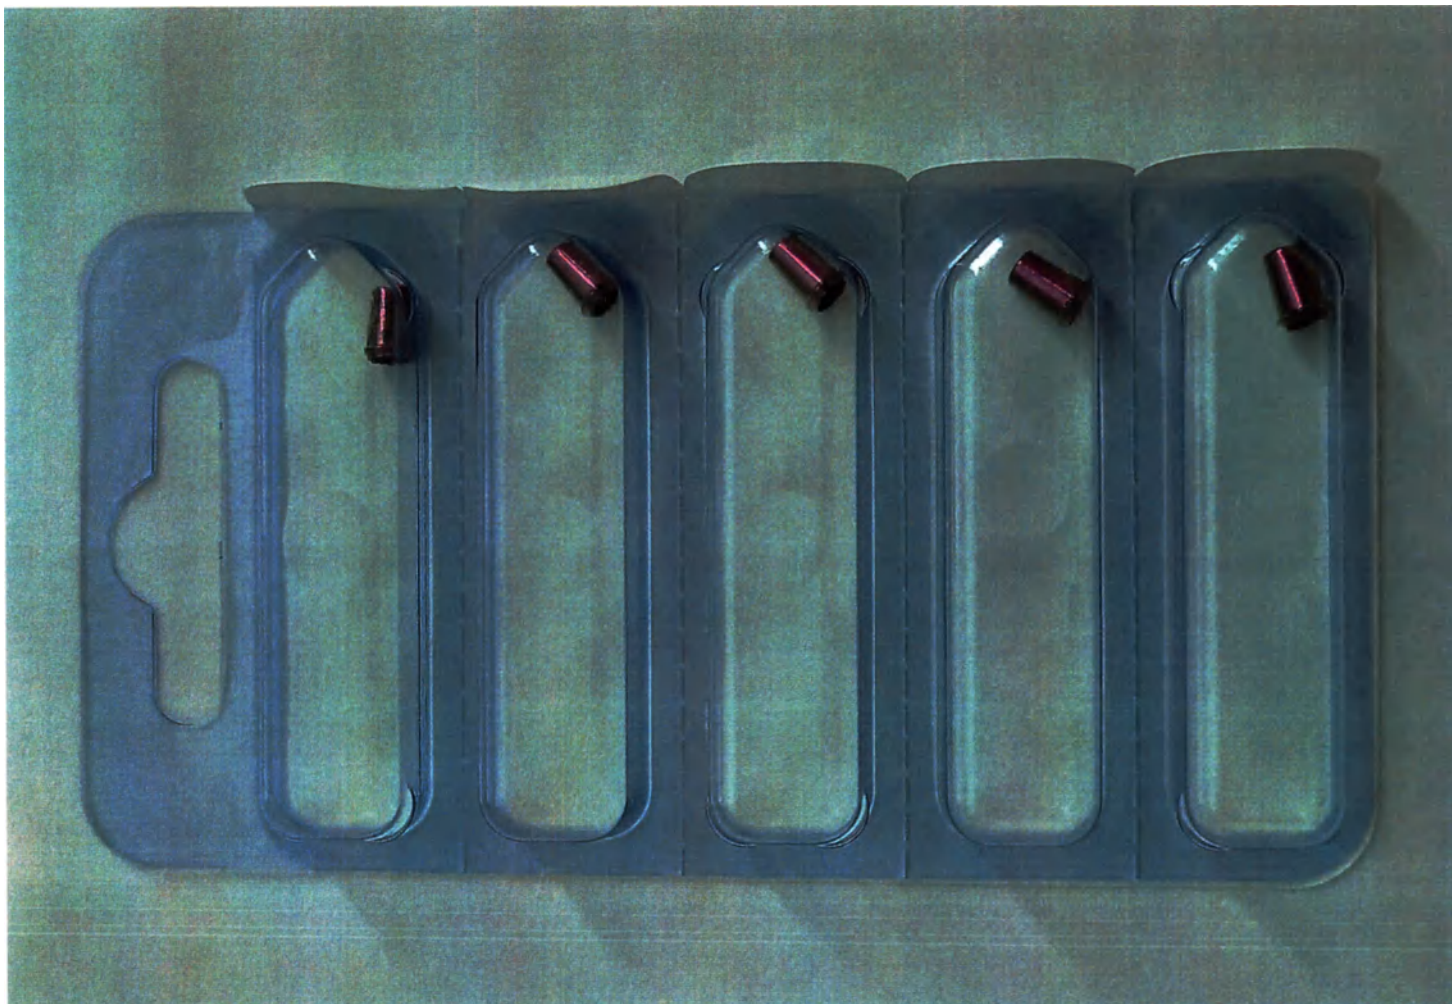

**Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К. (изделия в блистере в комплектации)**

REF TCKXS1 **LOT** XXX  XX XXXX

Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К

материал: Ti6Al4V


Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/406 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

**Макет этикетки на русском языке: Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, вариант исполнения:
TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. К.**


*** Маркировка на русском языке не перекрывает оригинальные символы, содержащиеся на заводской упаковке**

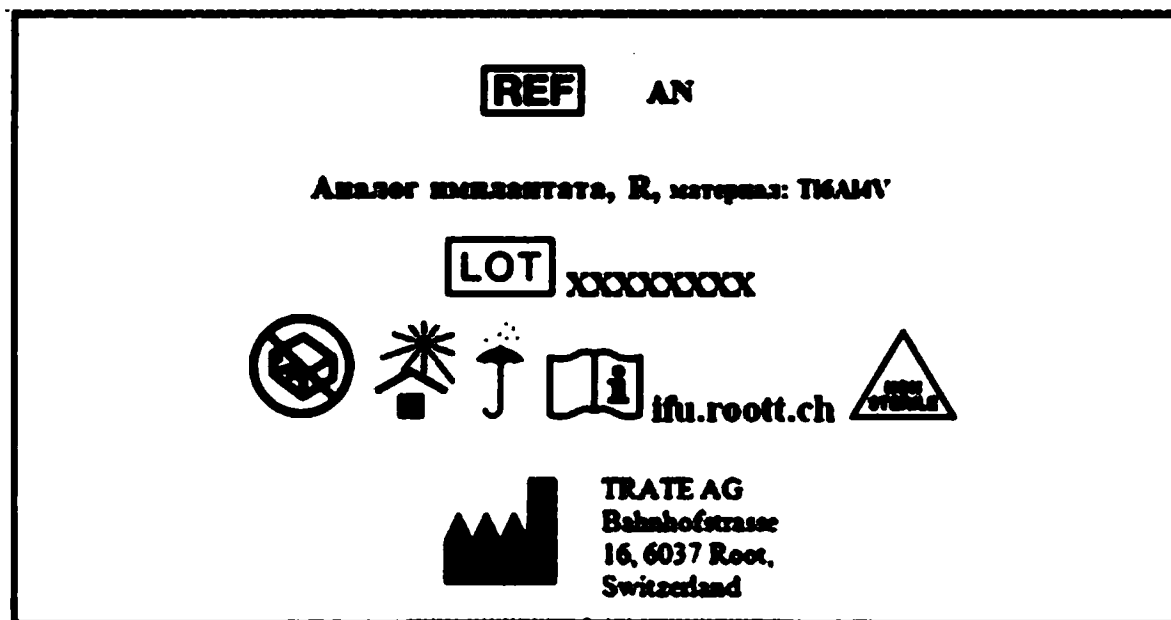

Макет транспортной маркировки на примере* МИ AN, Аналог имплантата, R

* Данный макет предоставлен в качестве примера. В строке наименования МИ «Аналог имплантата, R, материал: Ti6Al4V» указывается полное наименование любого соответствующего варианта исполнения медицинского изделия, для которого используется транспортная маркировка.



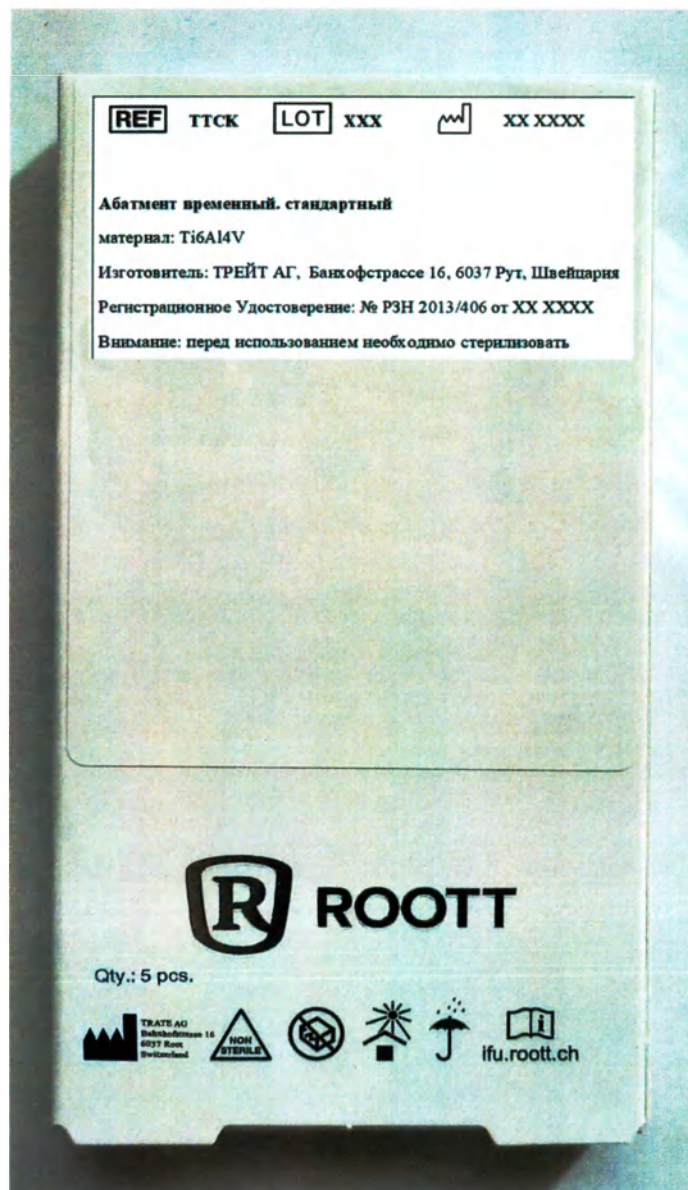

Пример расположения этикетки на русском языке на коробке для блистеров

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
87 (всего 87 листов) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ТРЕЙТ»

Романадзе М. О.

