

PHILIPS

«УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела
нормативного регулирования

ООО "ФИЛИПС"

Град А.А.

«26»

июня

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ультразвуковая серии 5000 Contrast с принадлежностями, варианты исполнения: 5300, 5500, 5500 CV»


I. Система ультразвуковая серии 5000 Contrast с принадлежностями, вариант исполнения 5300, в составе:




1. Блок основной ультразвуковой системы, в вариантах исполнения: 1.1. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5300G – 1 шт., или 1.2. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5300P – 1 шт., или 1.3. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5300W – 1 шт.




2. Тележка, варианты исполнения: 2.1. Тележка Standard – 1 шт. (при необходимости); 2.2. Тележка Extended – 1 шт. (при необходимости); 2.3. Тележка Deluxe – 1 шт. (при необходимости); 2.4. Тележка Premium с полкой для принтера – 1 шт. (при необходимости).

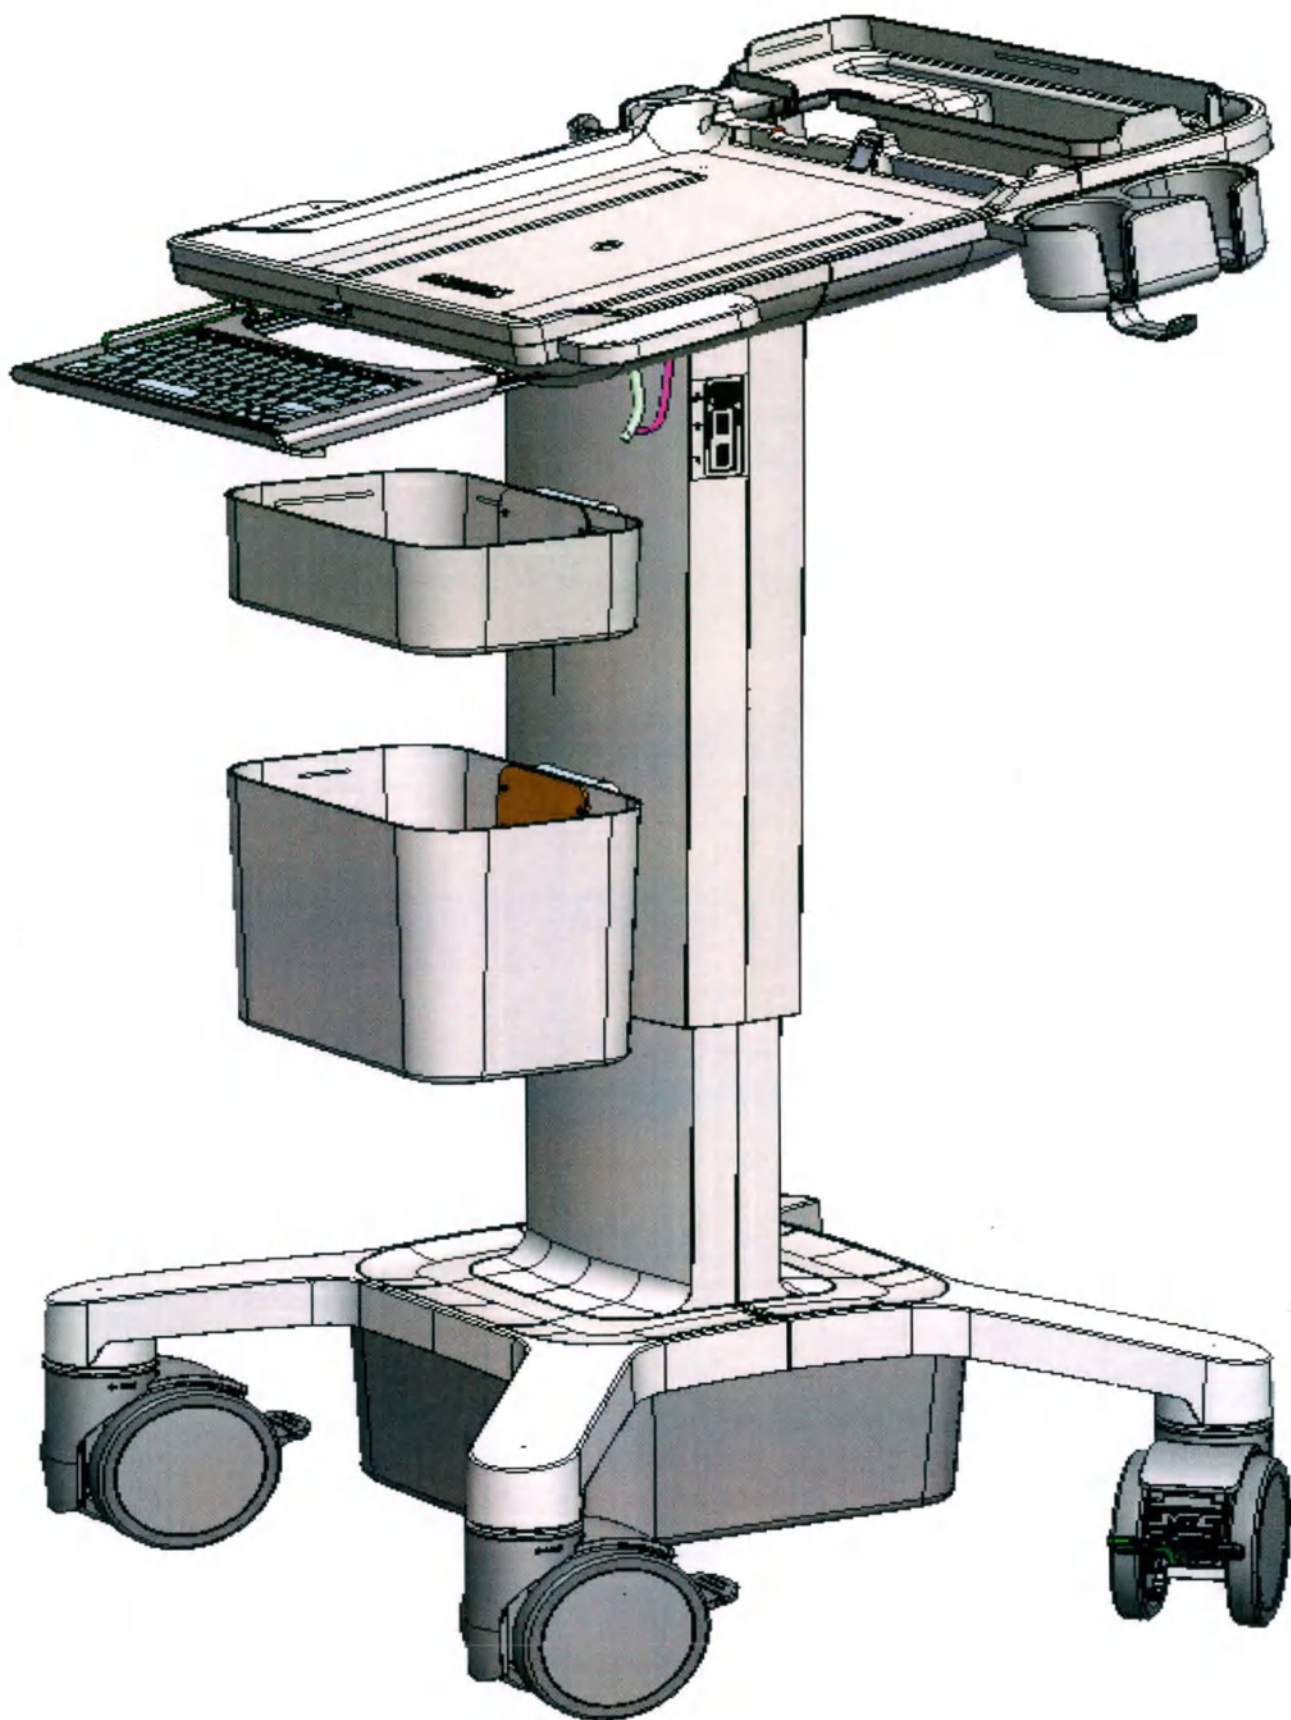


2.1. Тележка Standard – 1 шт. (при необходимости);

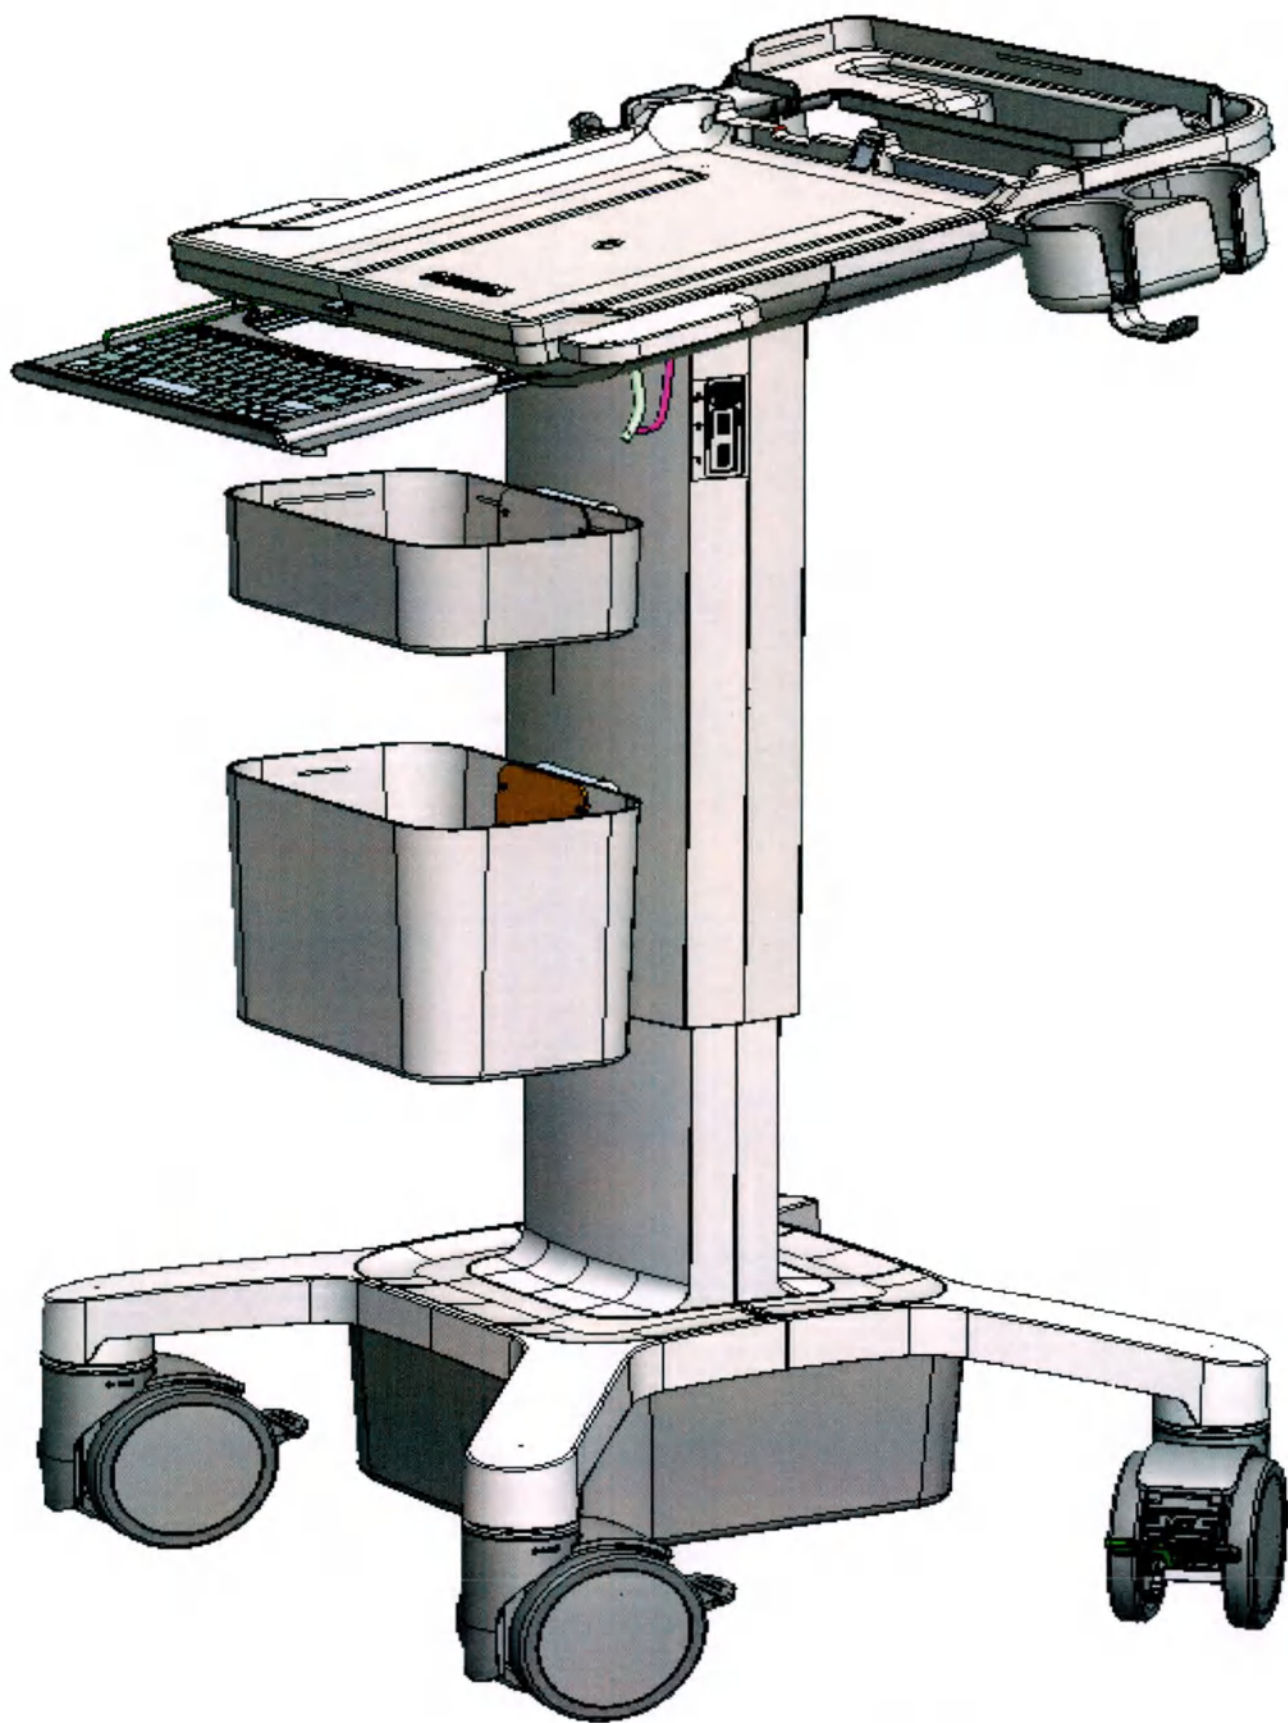


2.2. Тележка Extended – 1 шт. (при необходимости);

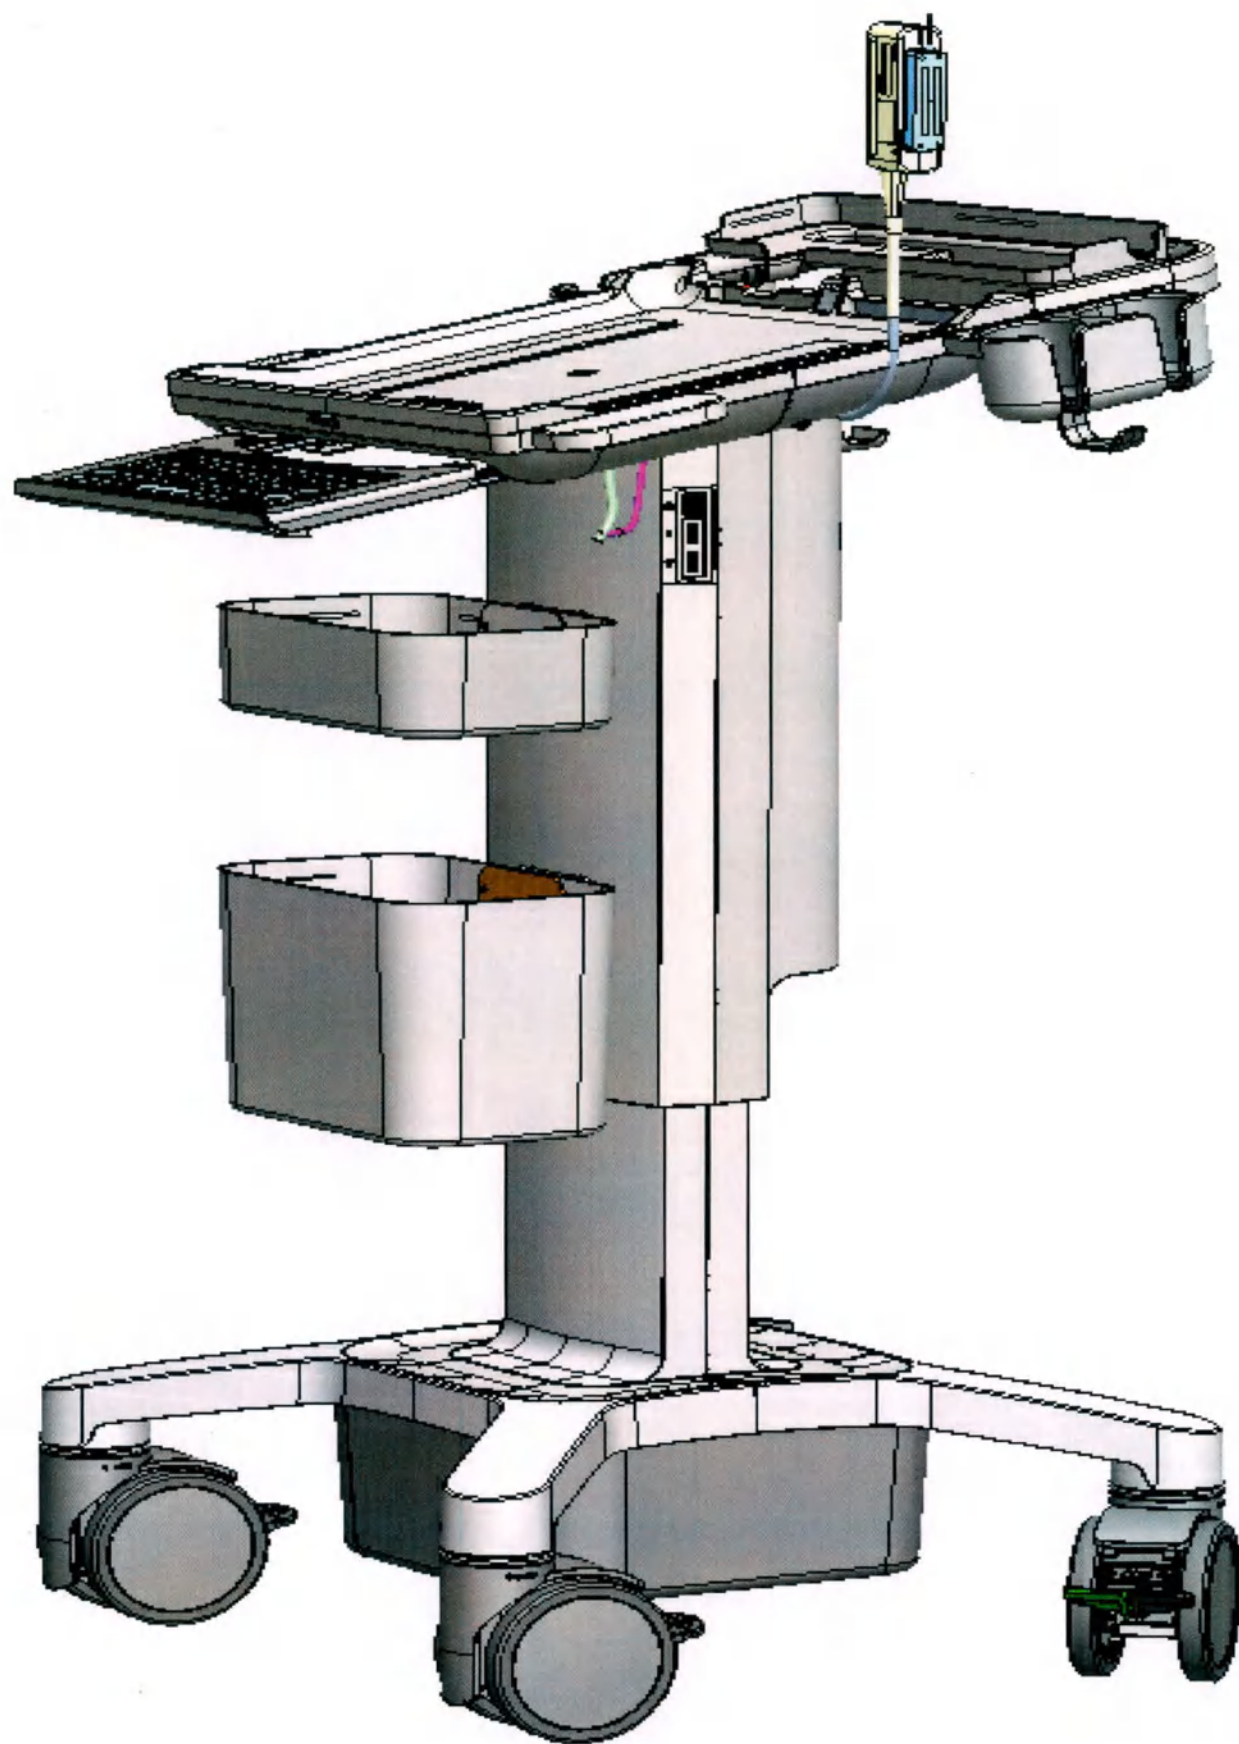

2.3. Тележка Deluxe – 1 шт. (при необходимости);

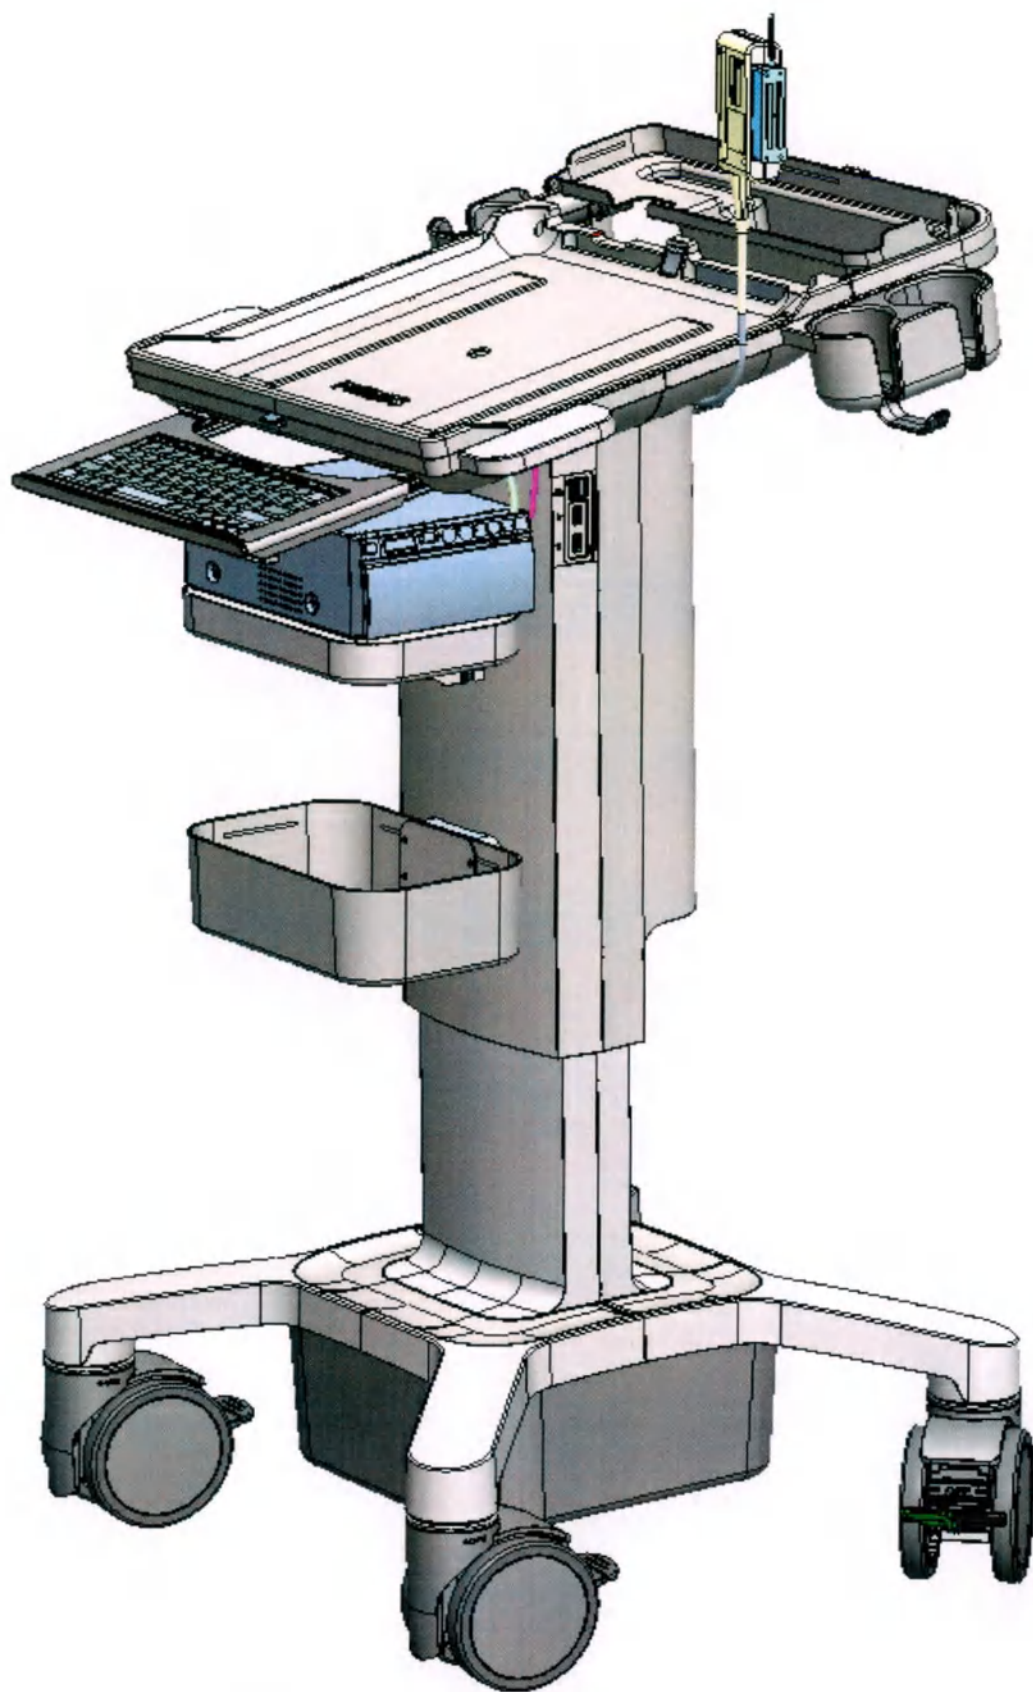


2.4. Тележка Premium с полкой для принтера – 1 шт. (при необходимости).

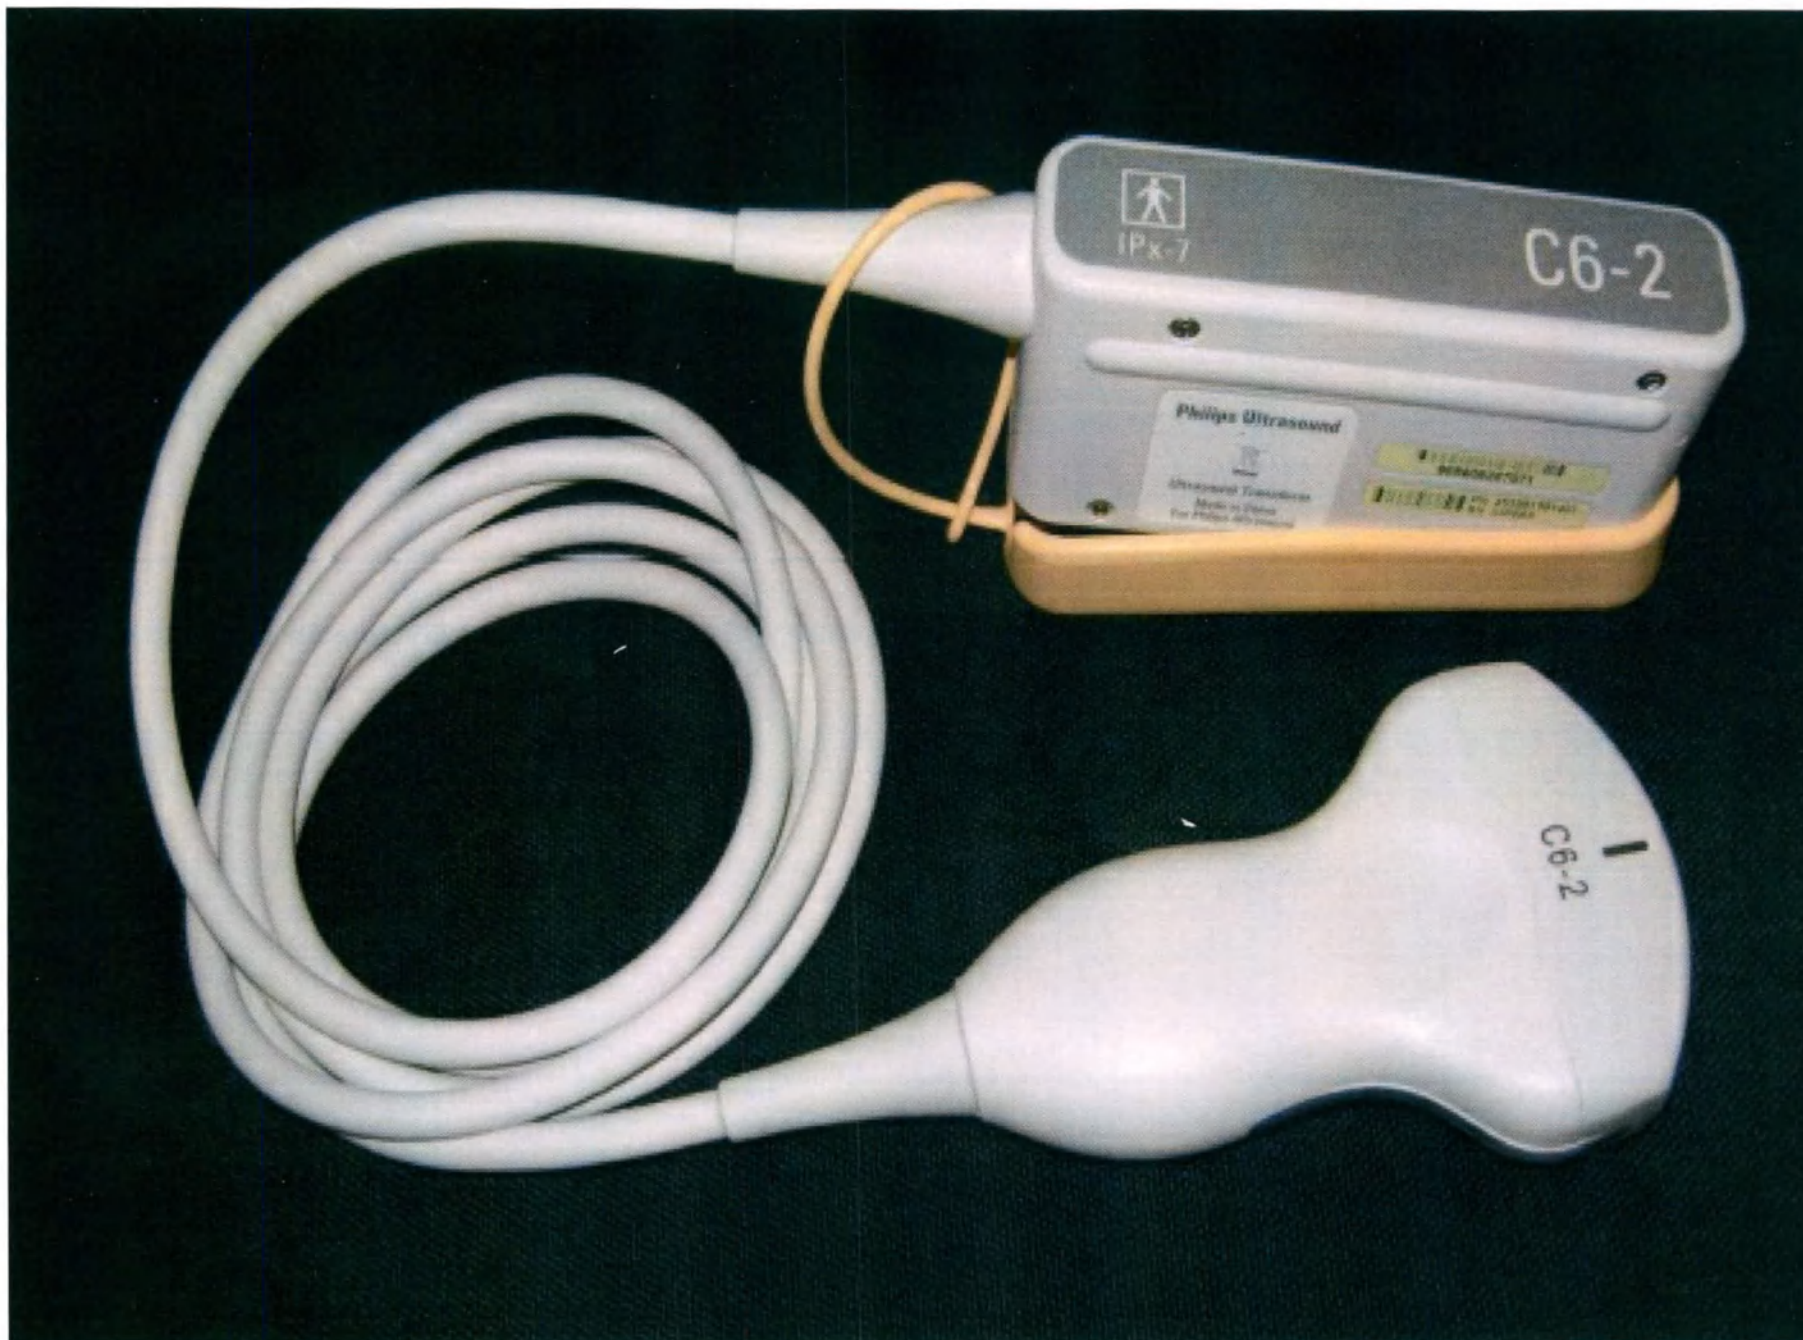


3. Датчик с конвексной матрицей C6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




4. Датчик с конвексной матрицей С8-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

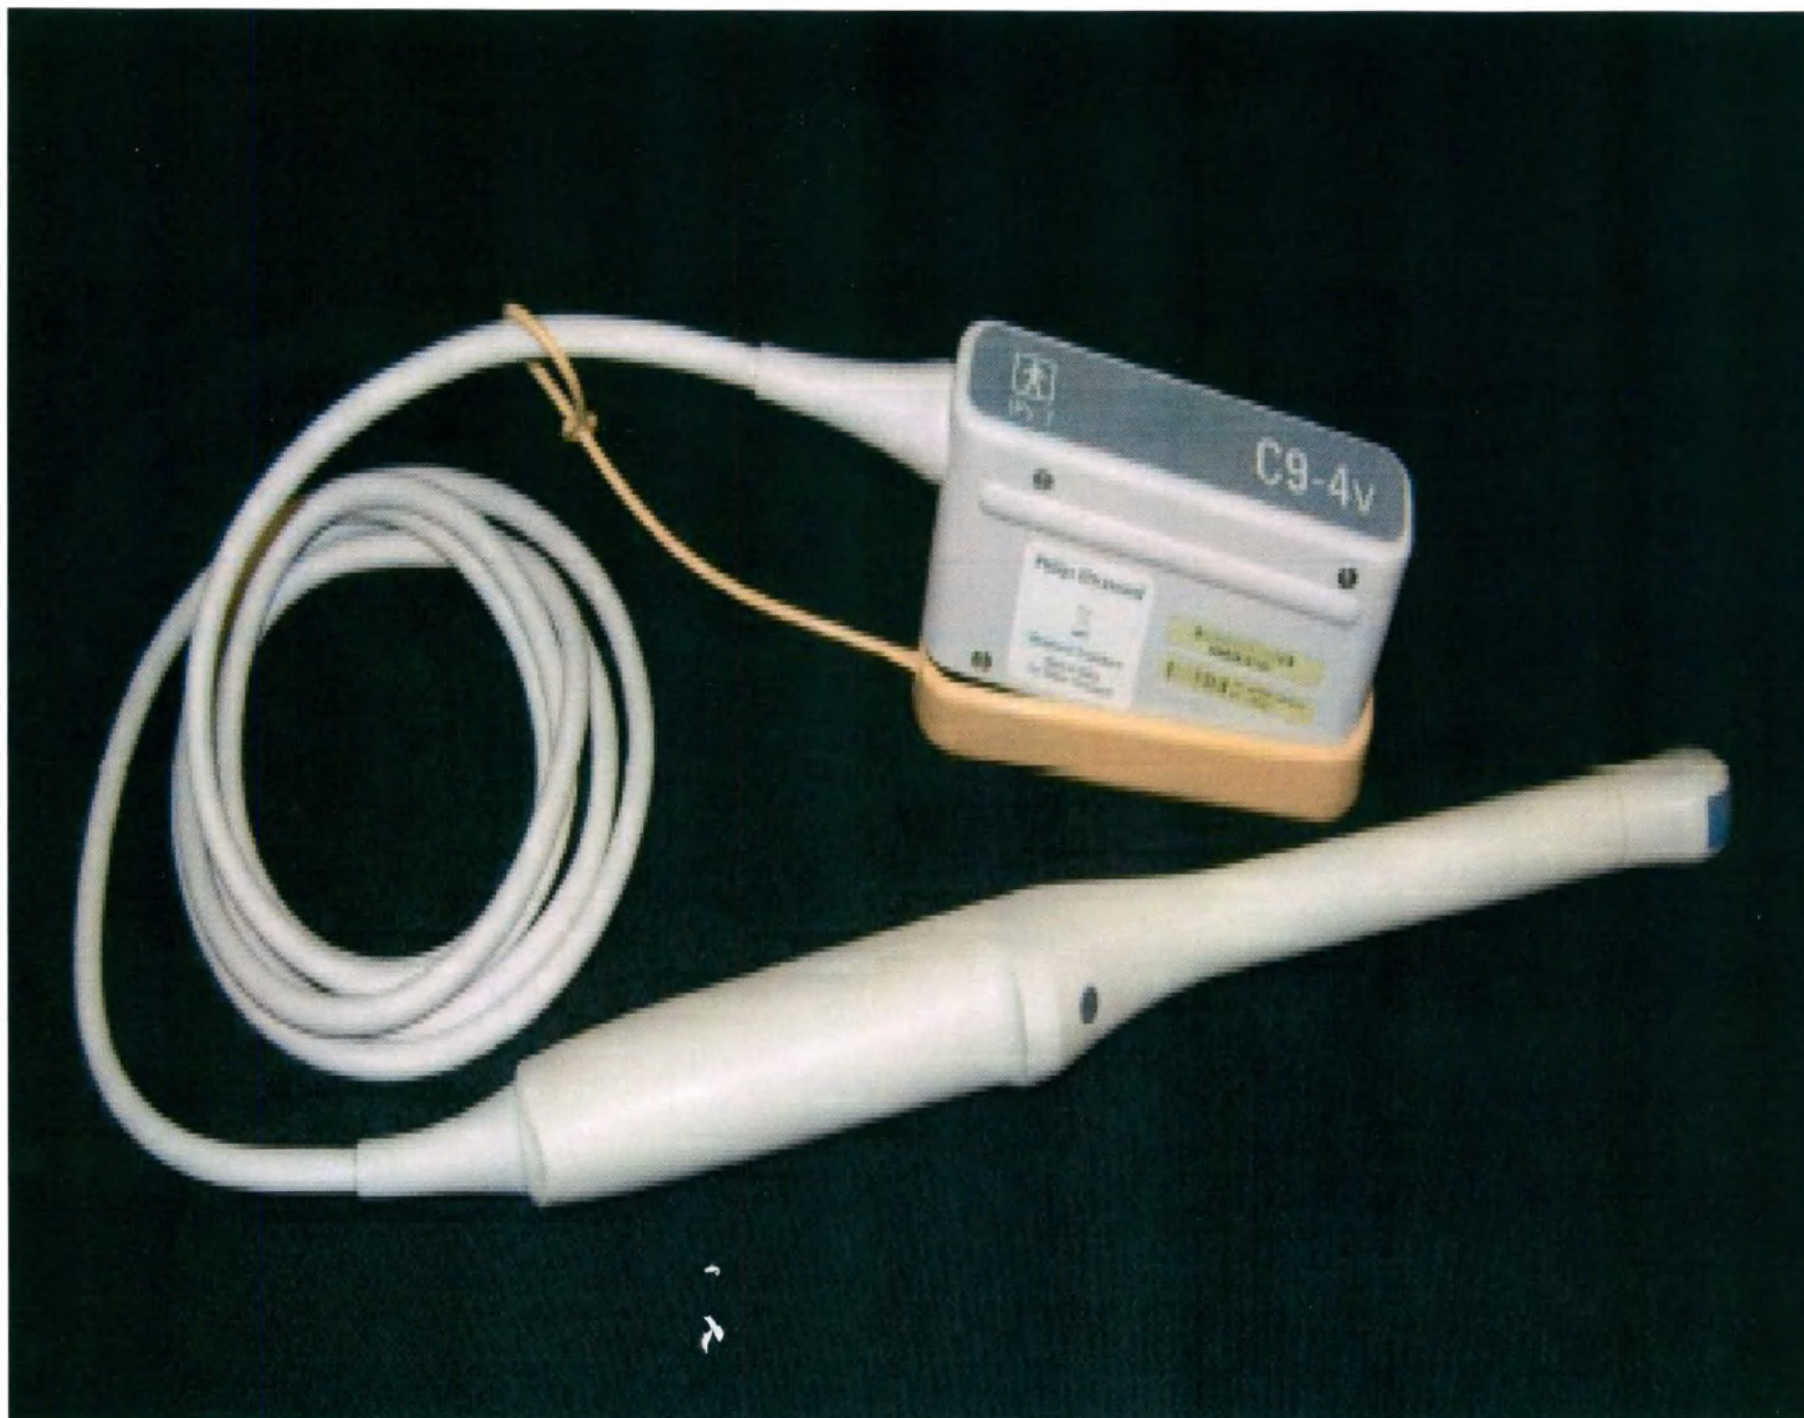

5. Датчик с конвексной матрицей C9-4v, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

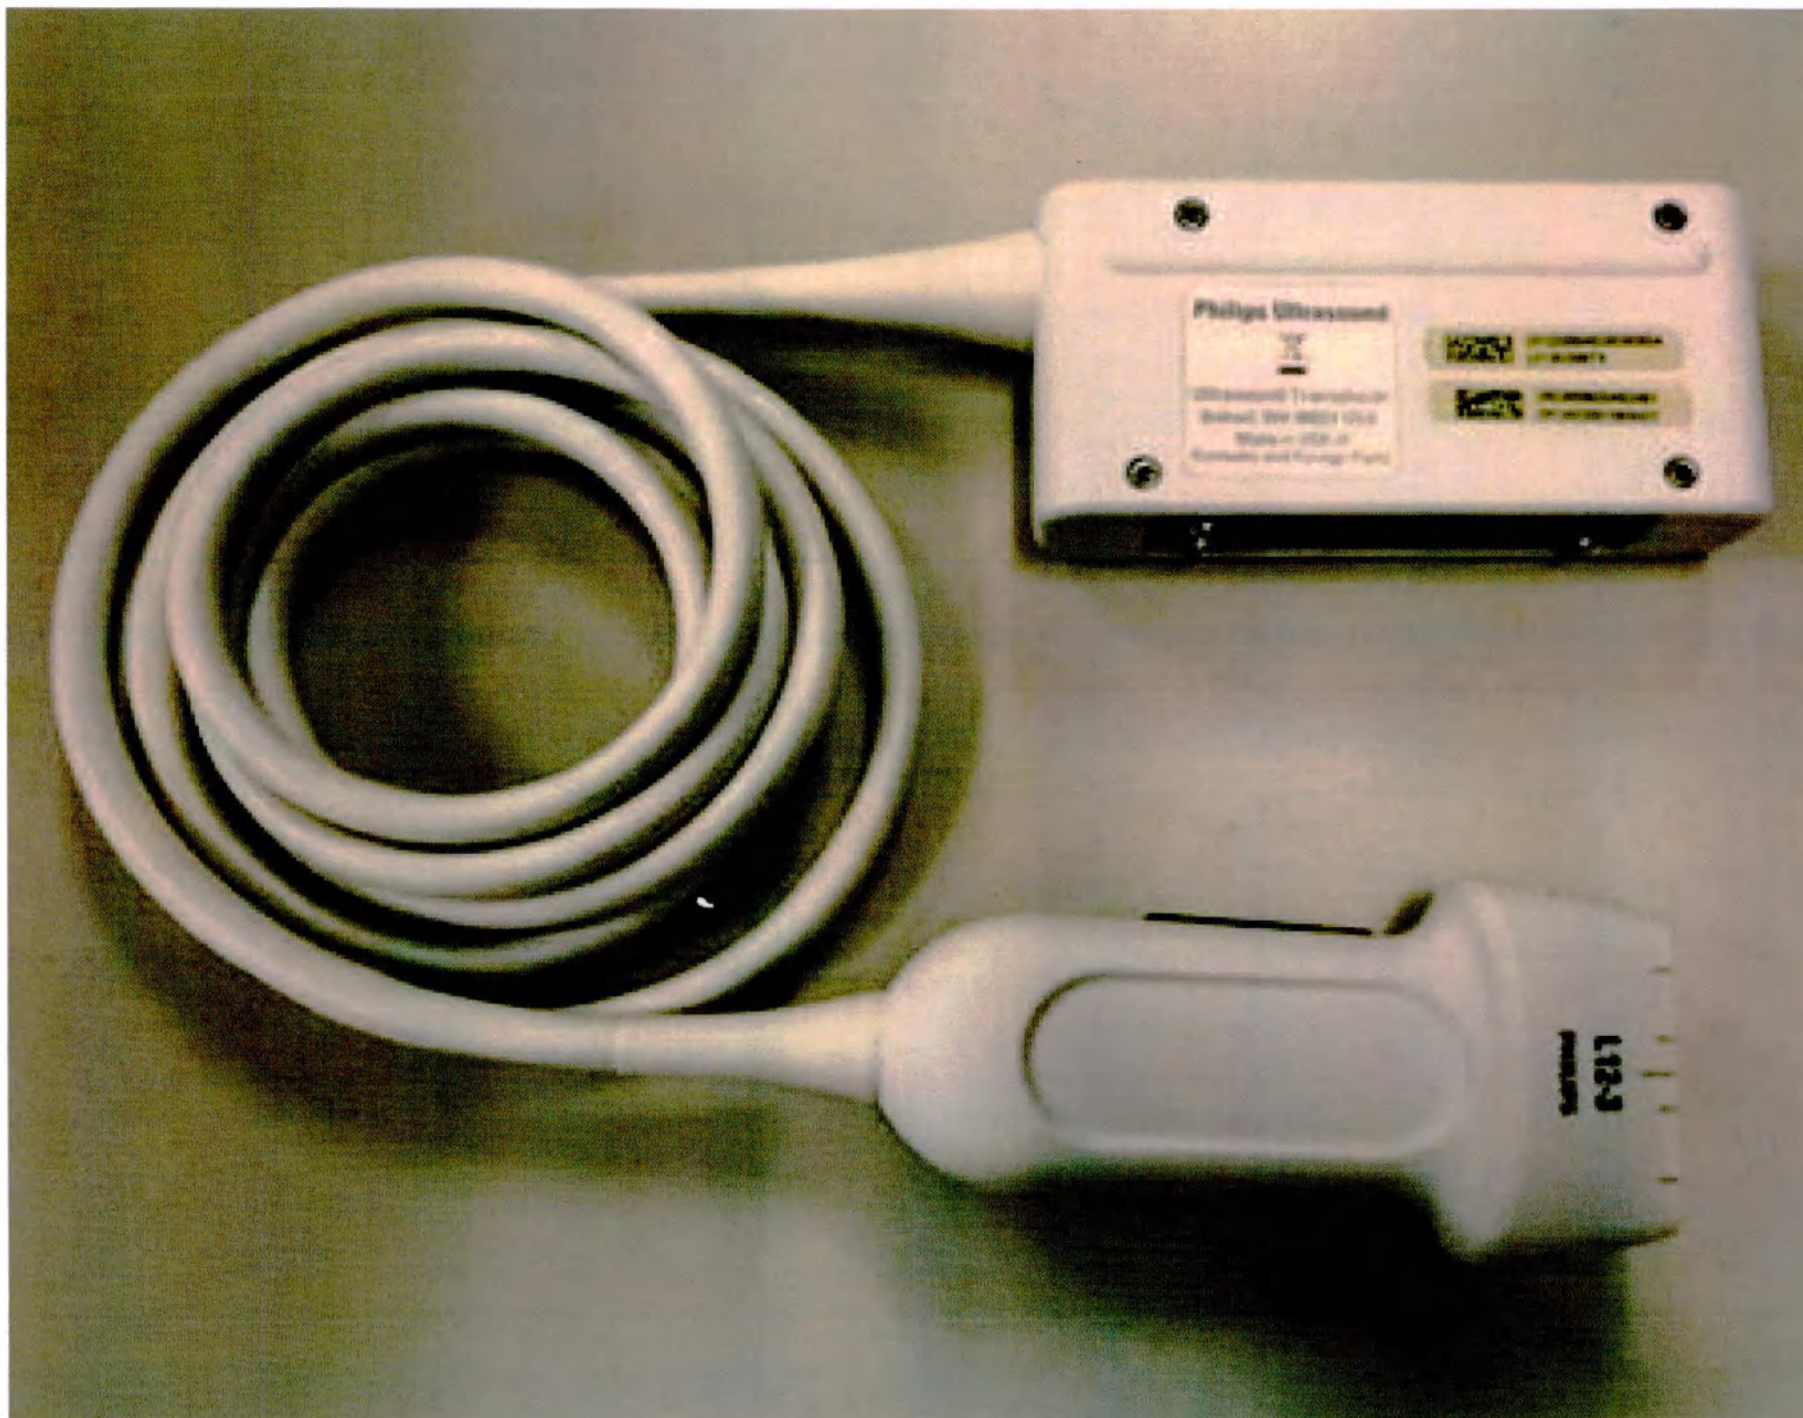

6. Датчик с линейной матрицей L12-3 ERGO, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

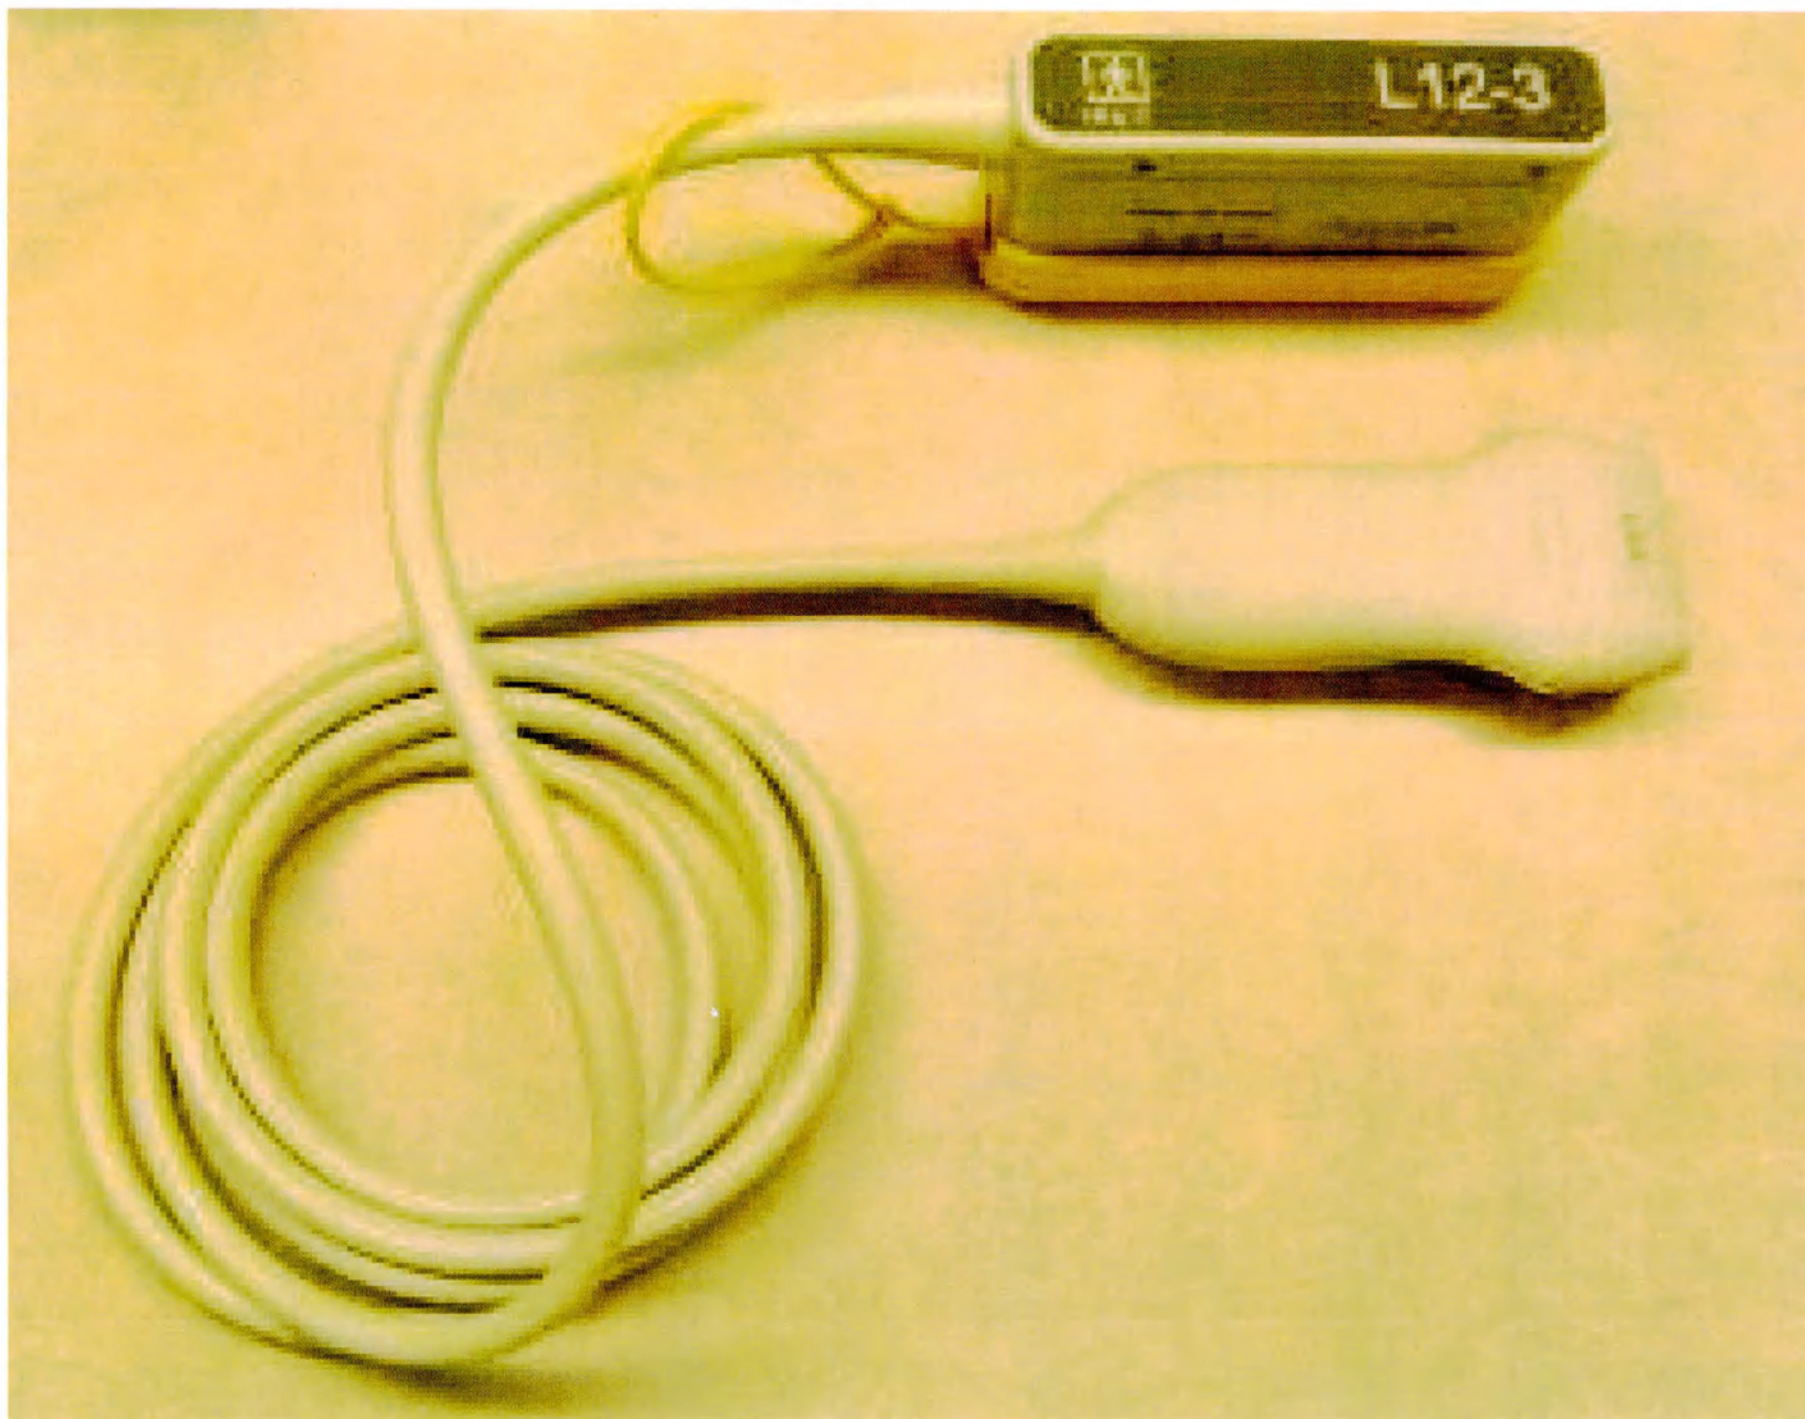


7. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



7. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



8. Датчик с линейной матрицей L12-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

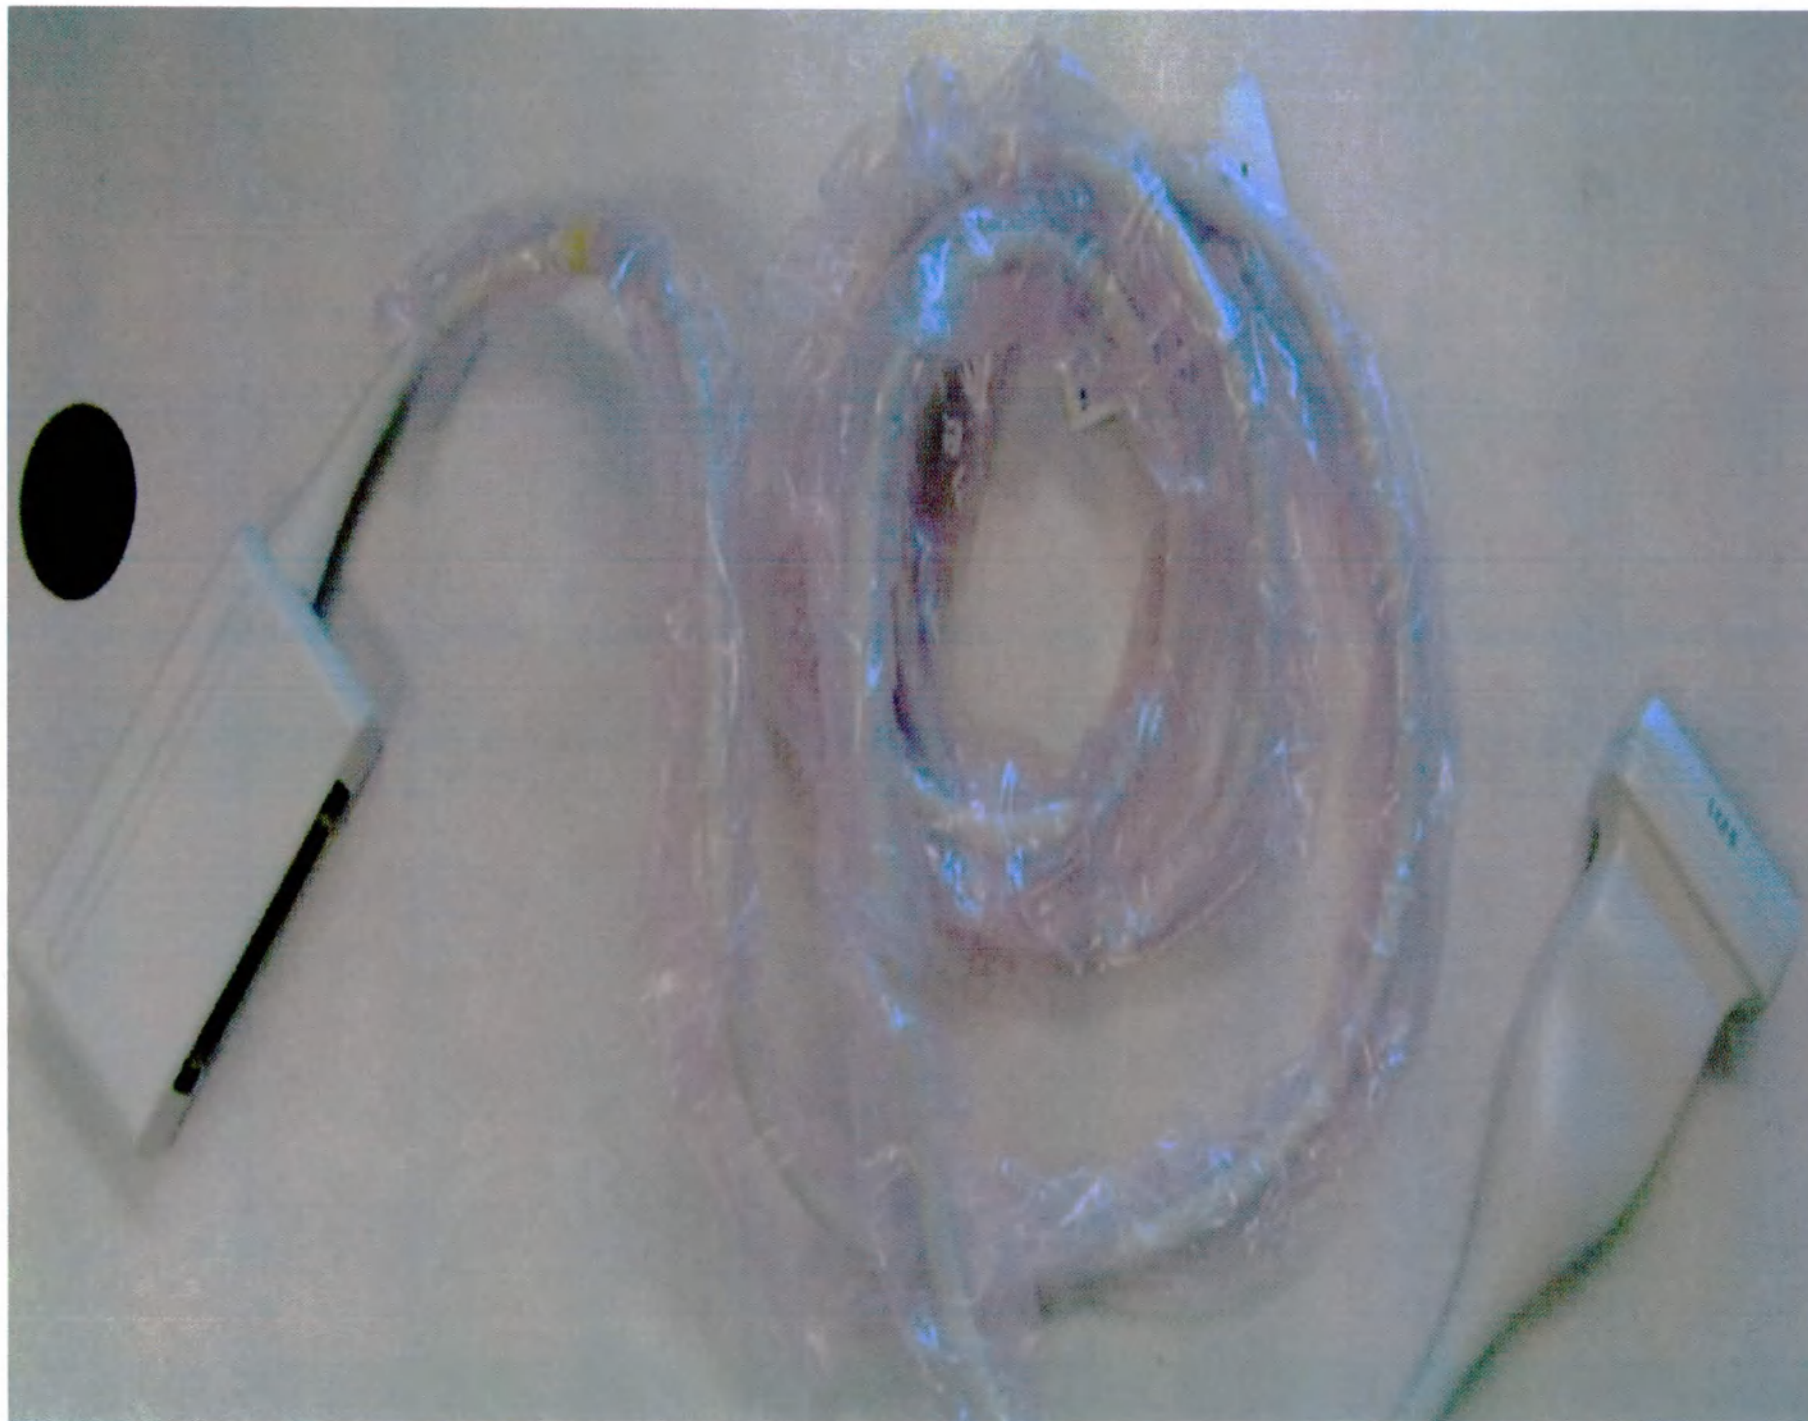

9. Датчик с линейной матрицей L12-5 50, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




10. Датчик с линейной матрицей L15-7io, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости). – не более 15 шт. (при необходимости);




11. Датчик с линейной матрицей L18-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости). – не более 15 шт. (при необходимости);




12. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

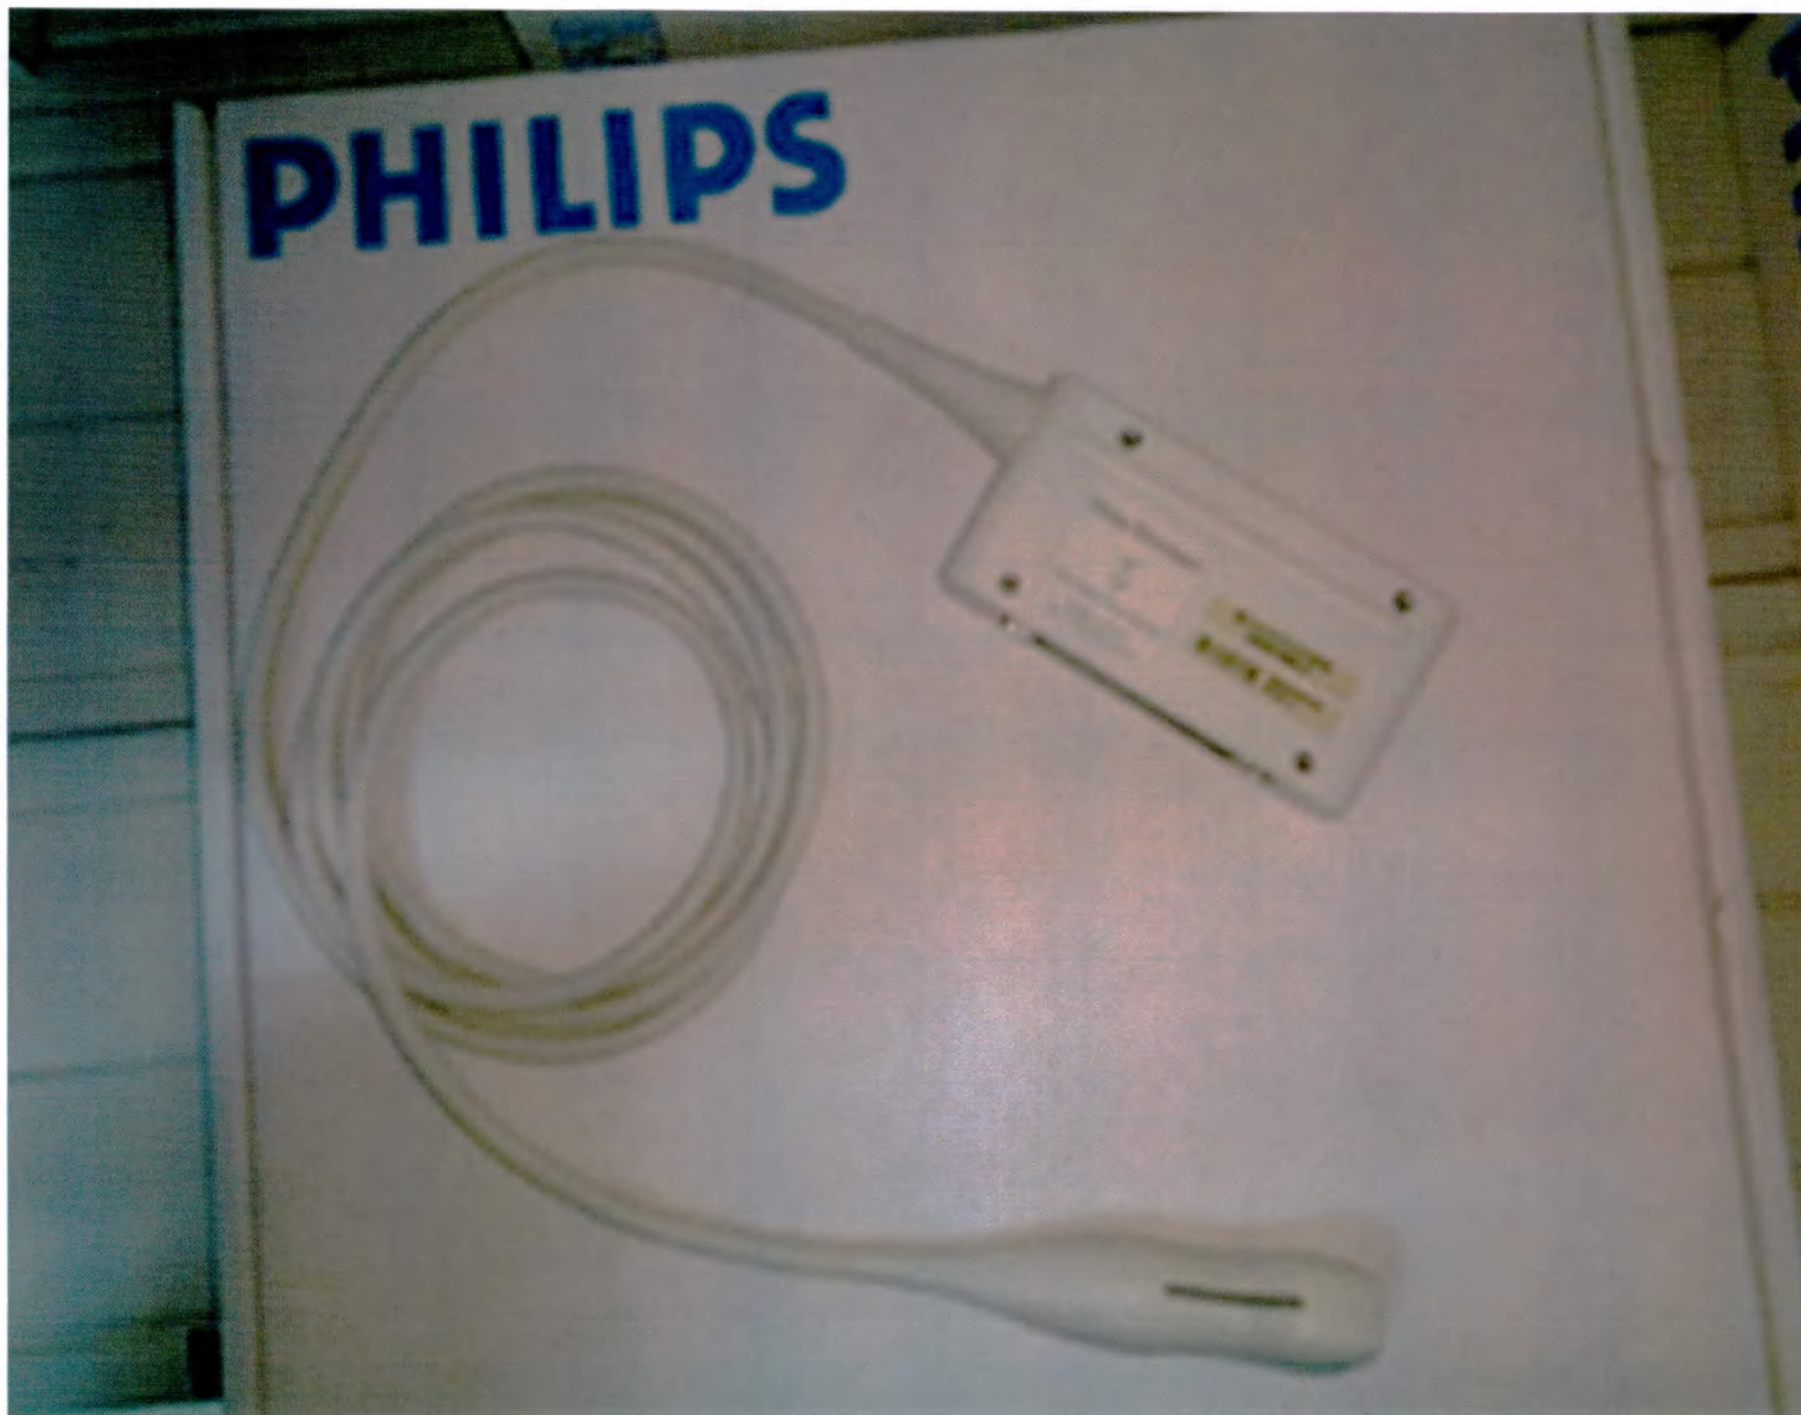

12. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)

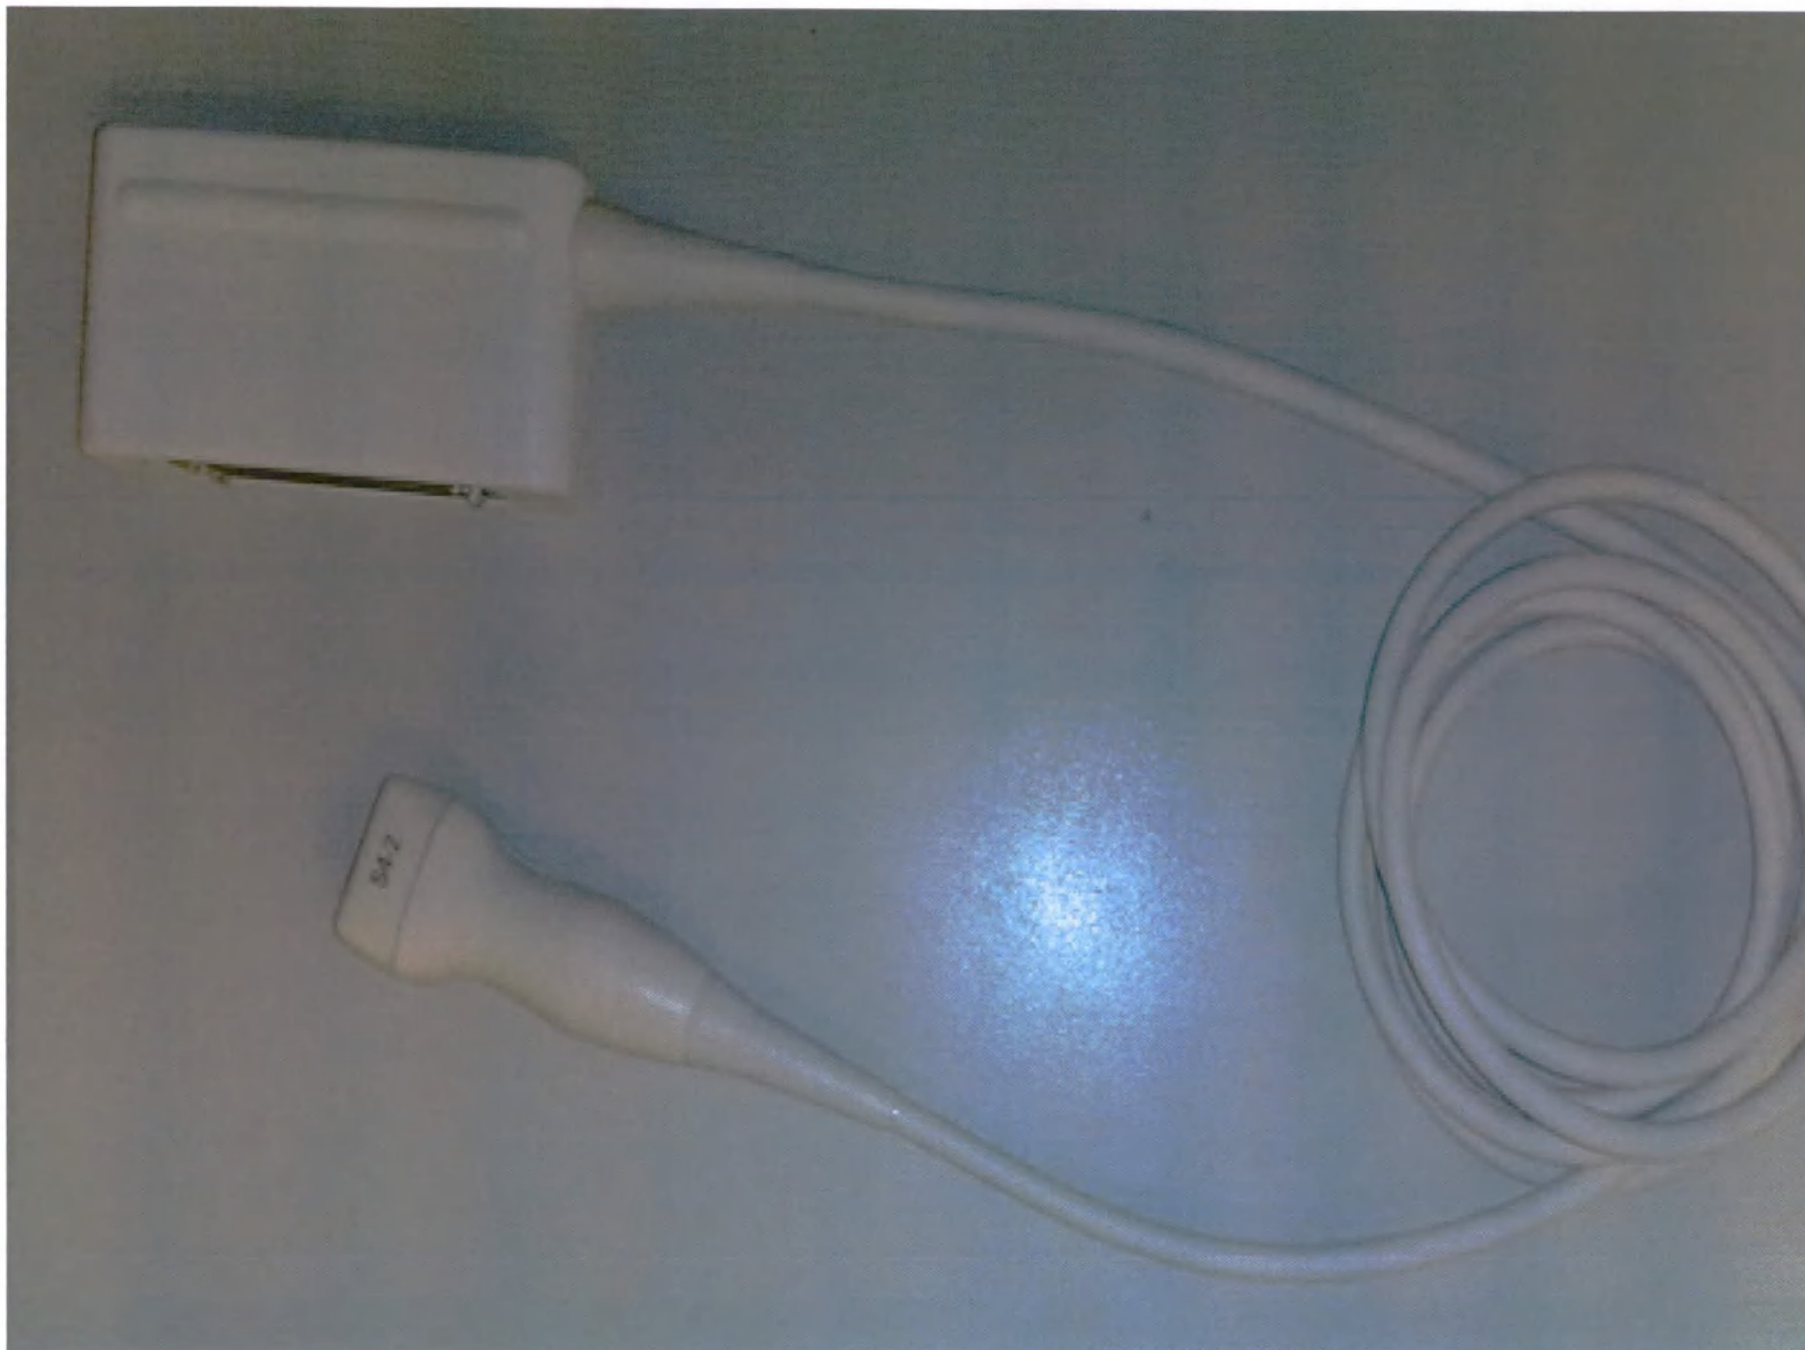


13. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S4-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

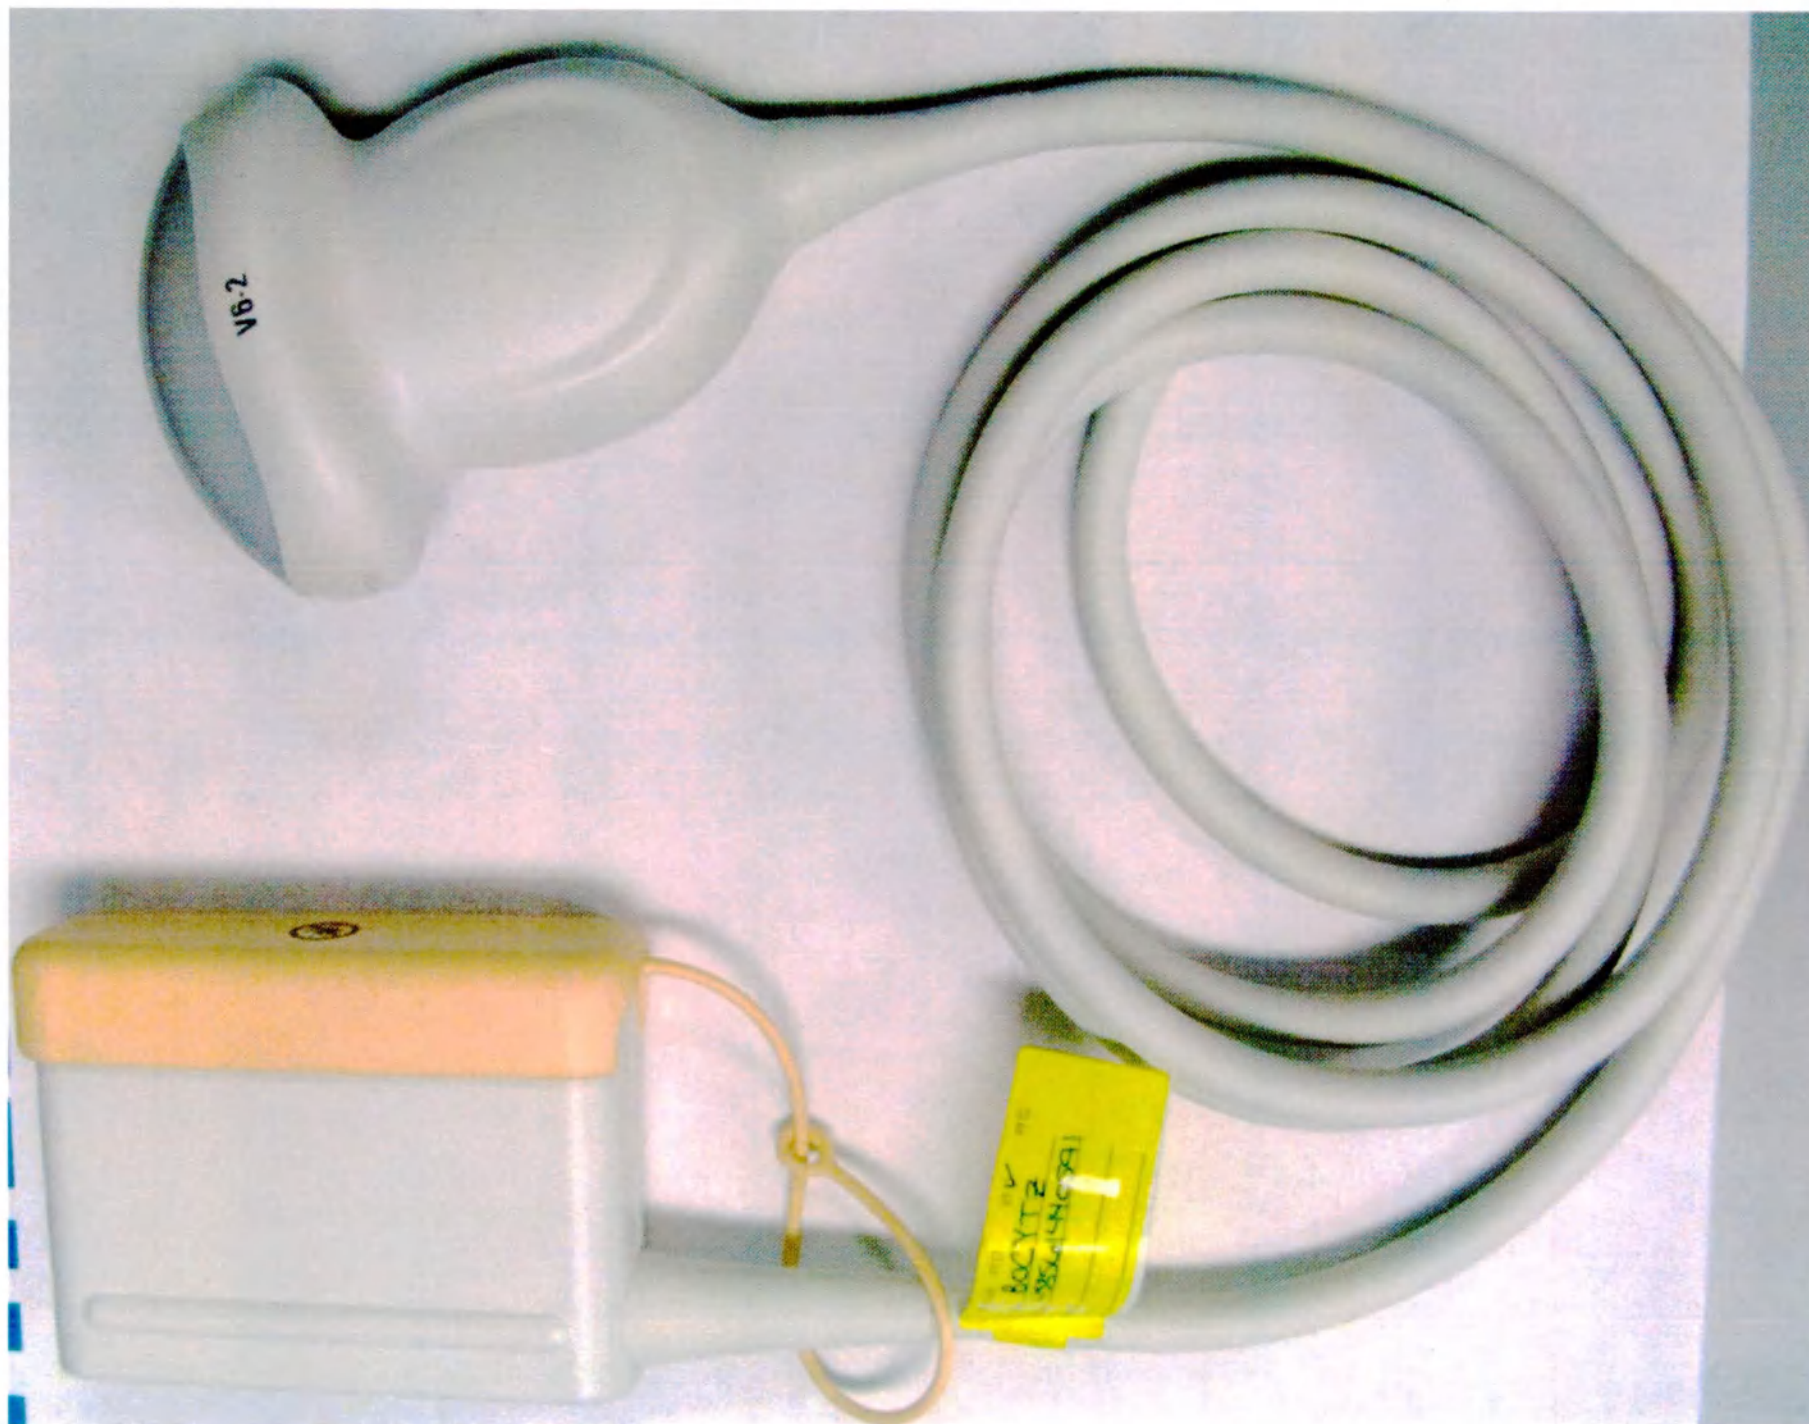


14. Датчик с конвексной матрицей V6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



15. Датчик с конвексной матрицей 3D9-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

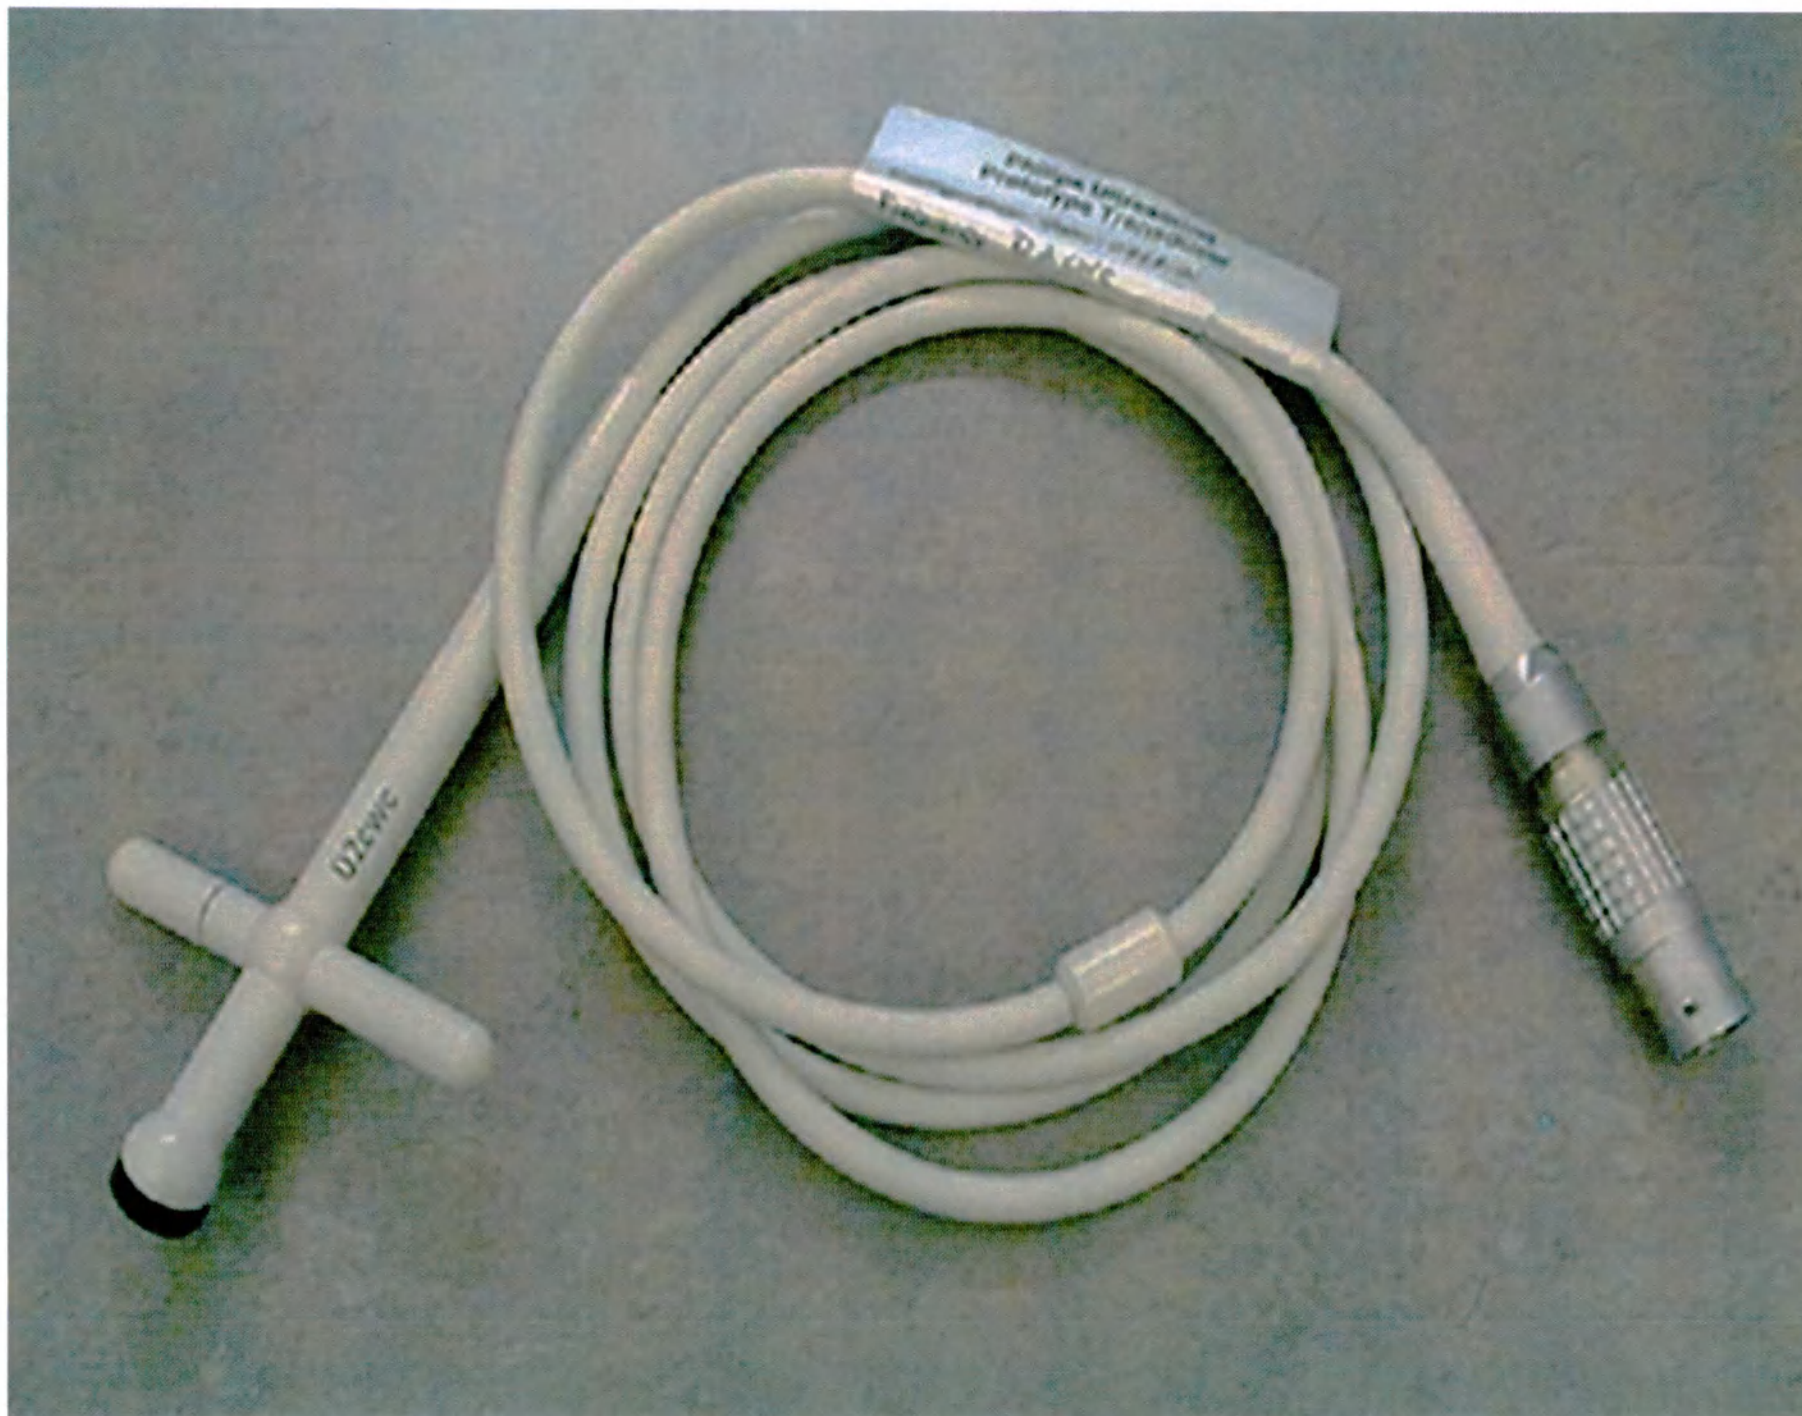


16. Датчик карандашный (волновой) D2cwc, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

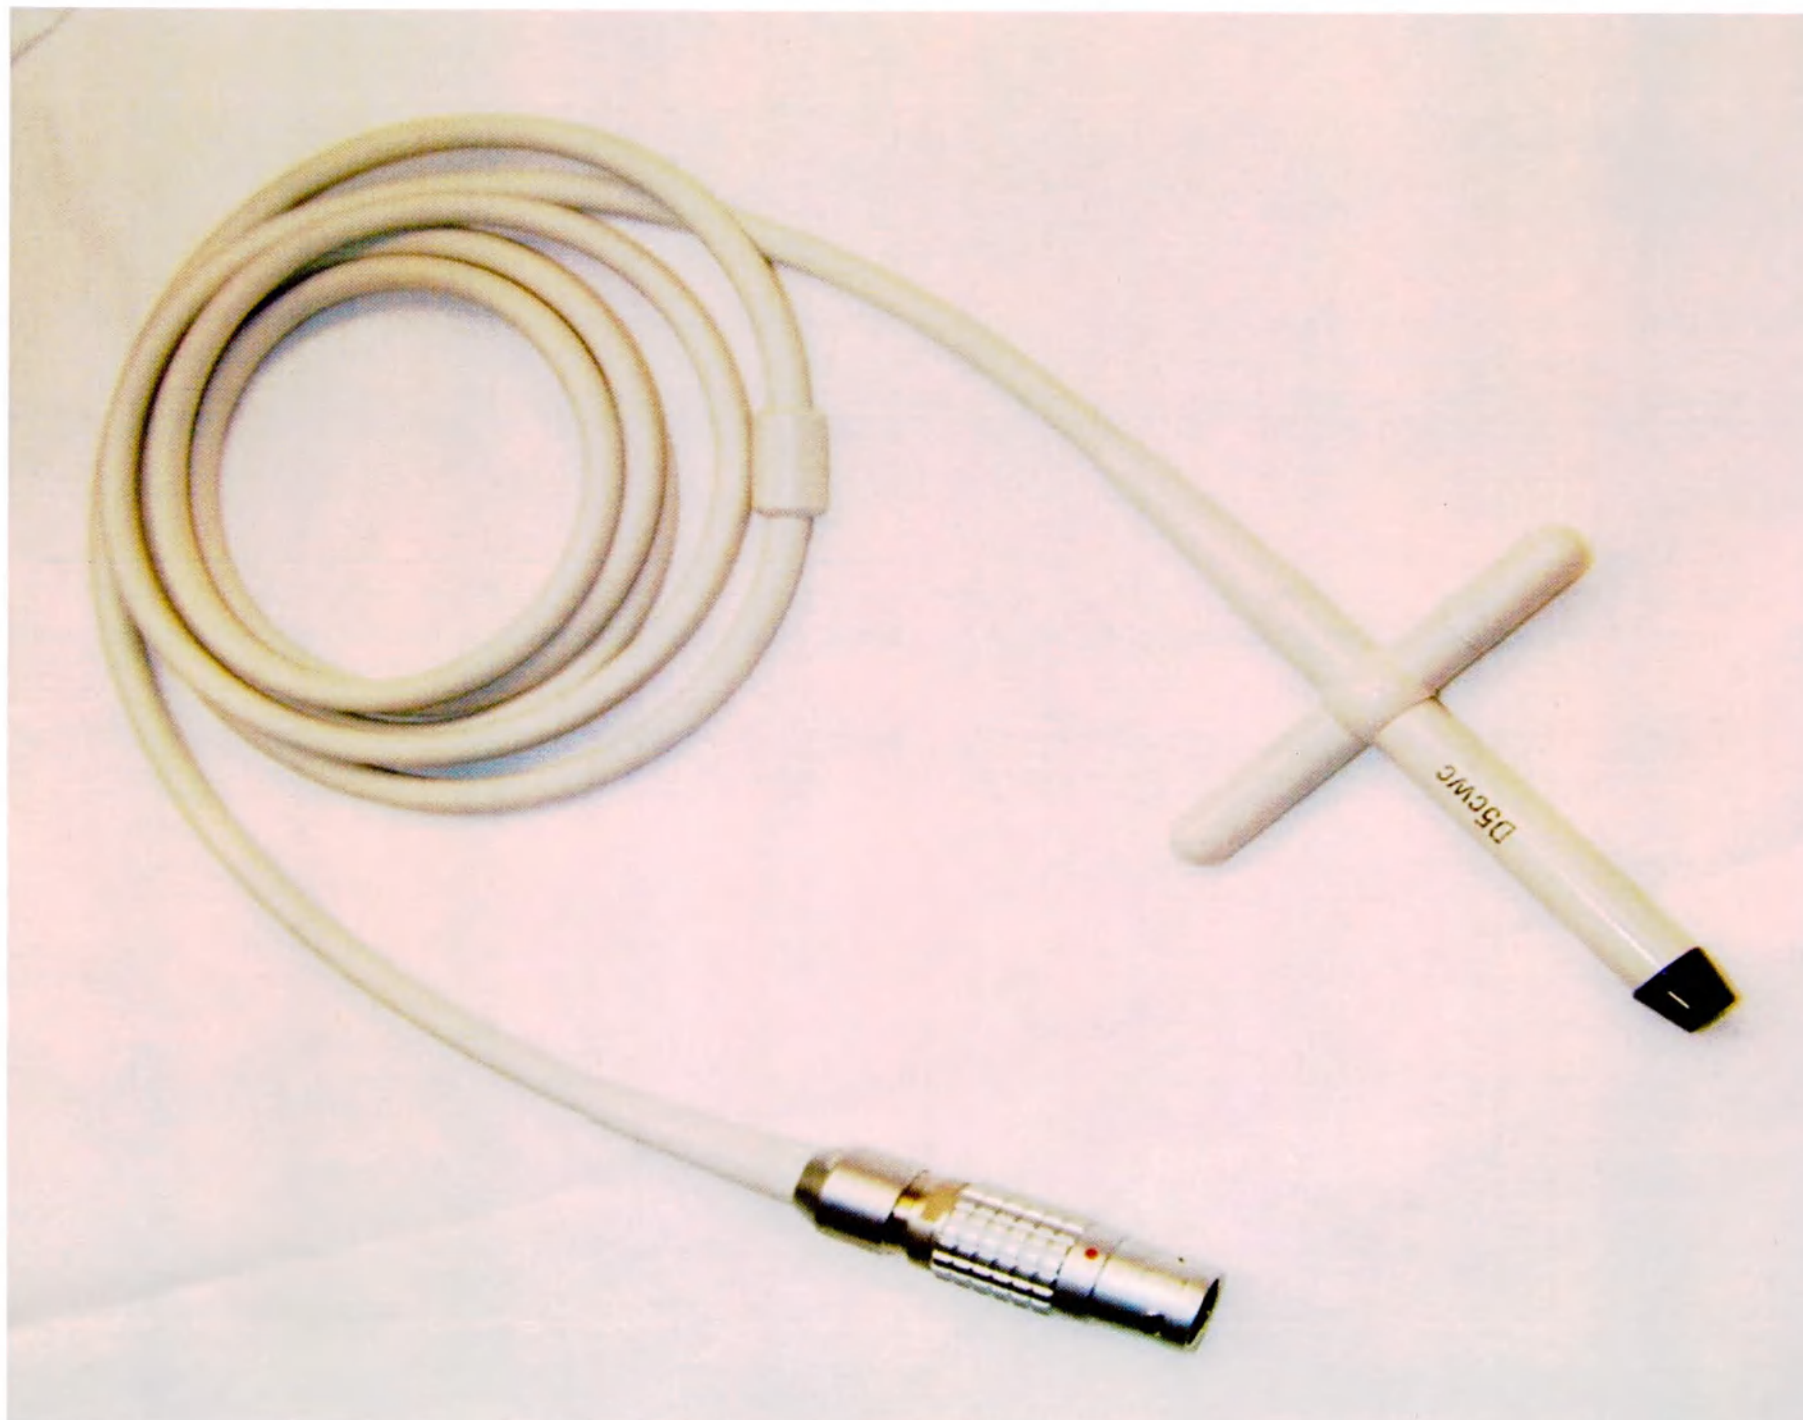


17. Датчик карандашный (волновой) D5cwc, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




18. Датчик карандашный (волновой) D2tcd, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

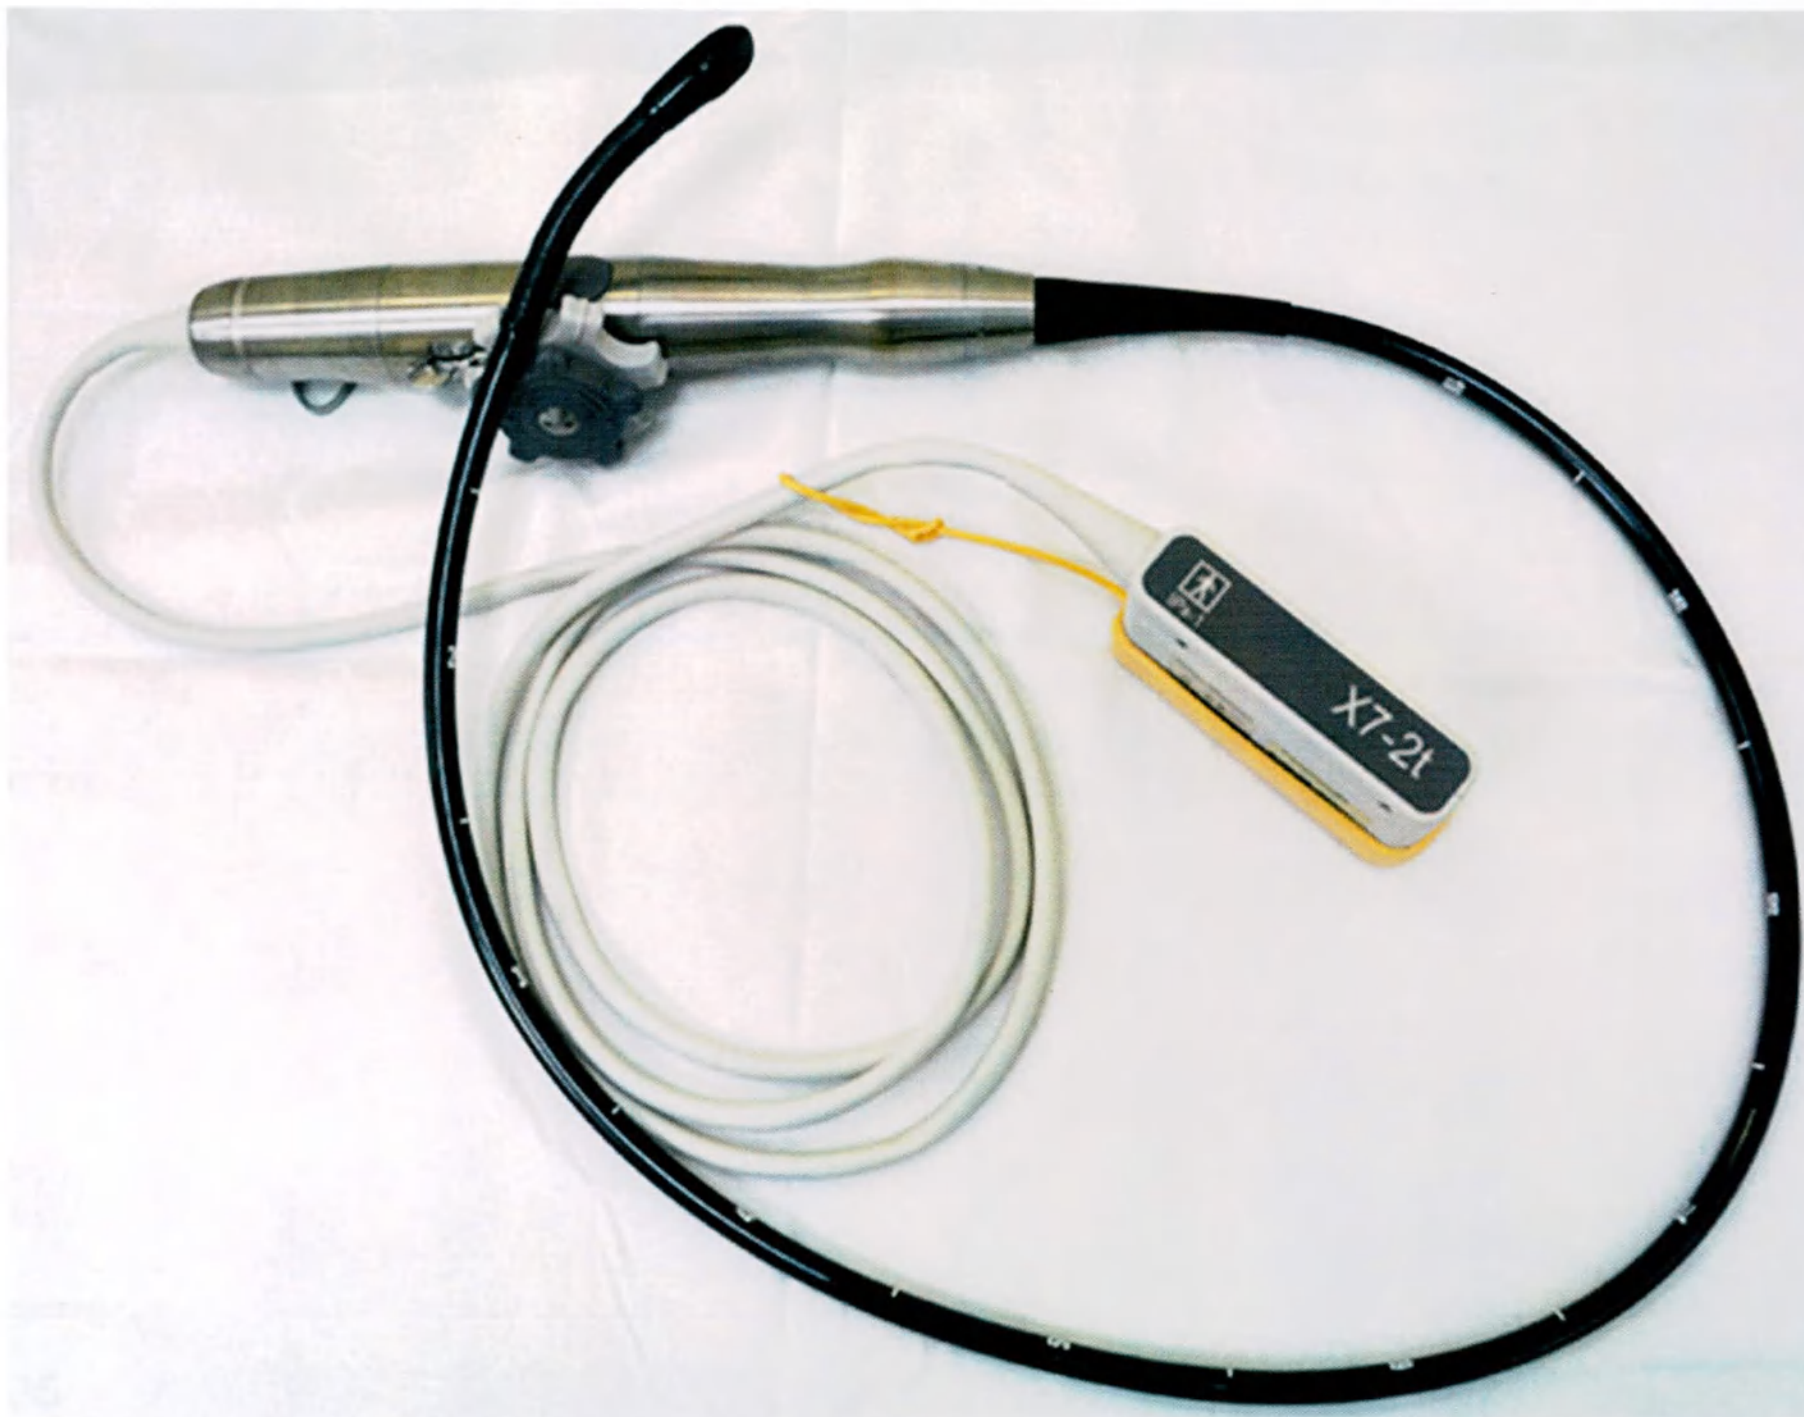

19. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X7-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

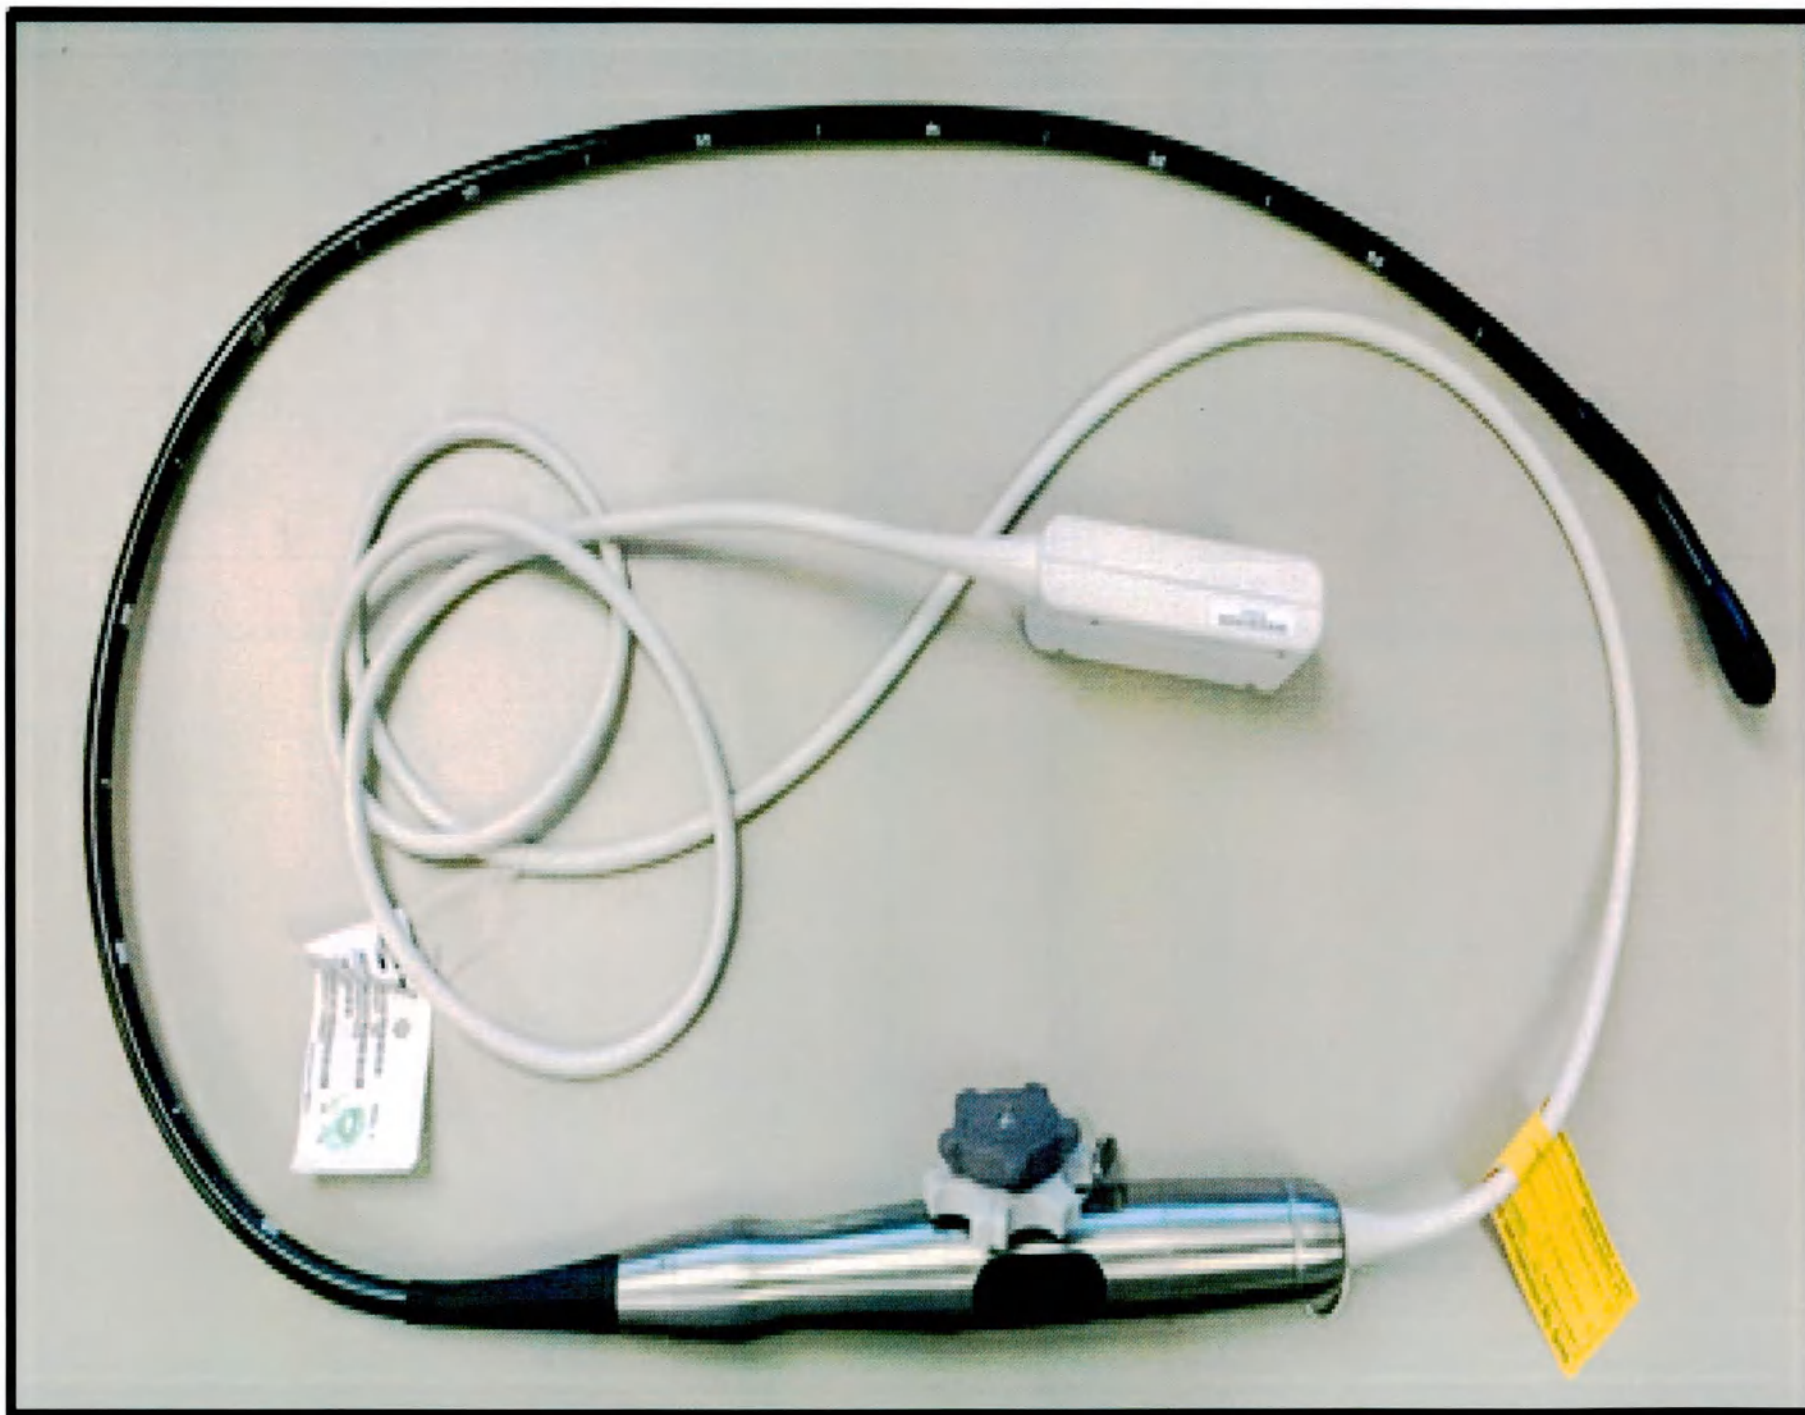

20. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X8-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

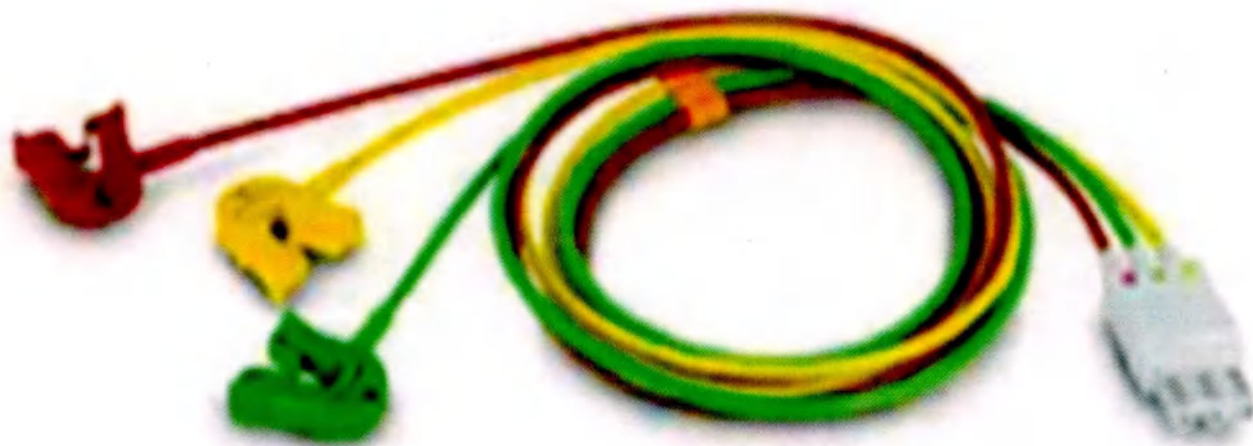

21. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для взрослых – не более 15 шт. (при необходимости).



22. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для детей – не более 15 шт. (при необходимости).



23. Кабель вспомогательного входного сигнала – не более 15 шт. (при необходимости).




24. Кабель ЭКГ, длина не более 3 м – не более 15 шт. (при необходимости). – не более 15 шт. (при необходимости).



25. Шнур питания европейский 4,28 м – не более 5 шт.



26. 26. Адаптер переменного тока – не более 5 шт. (при необходимости).

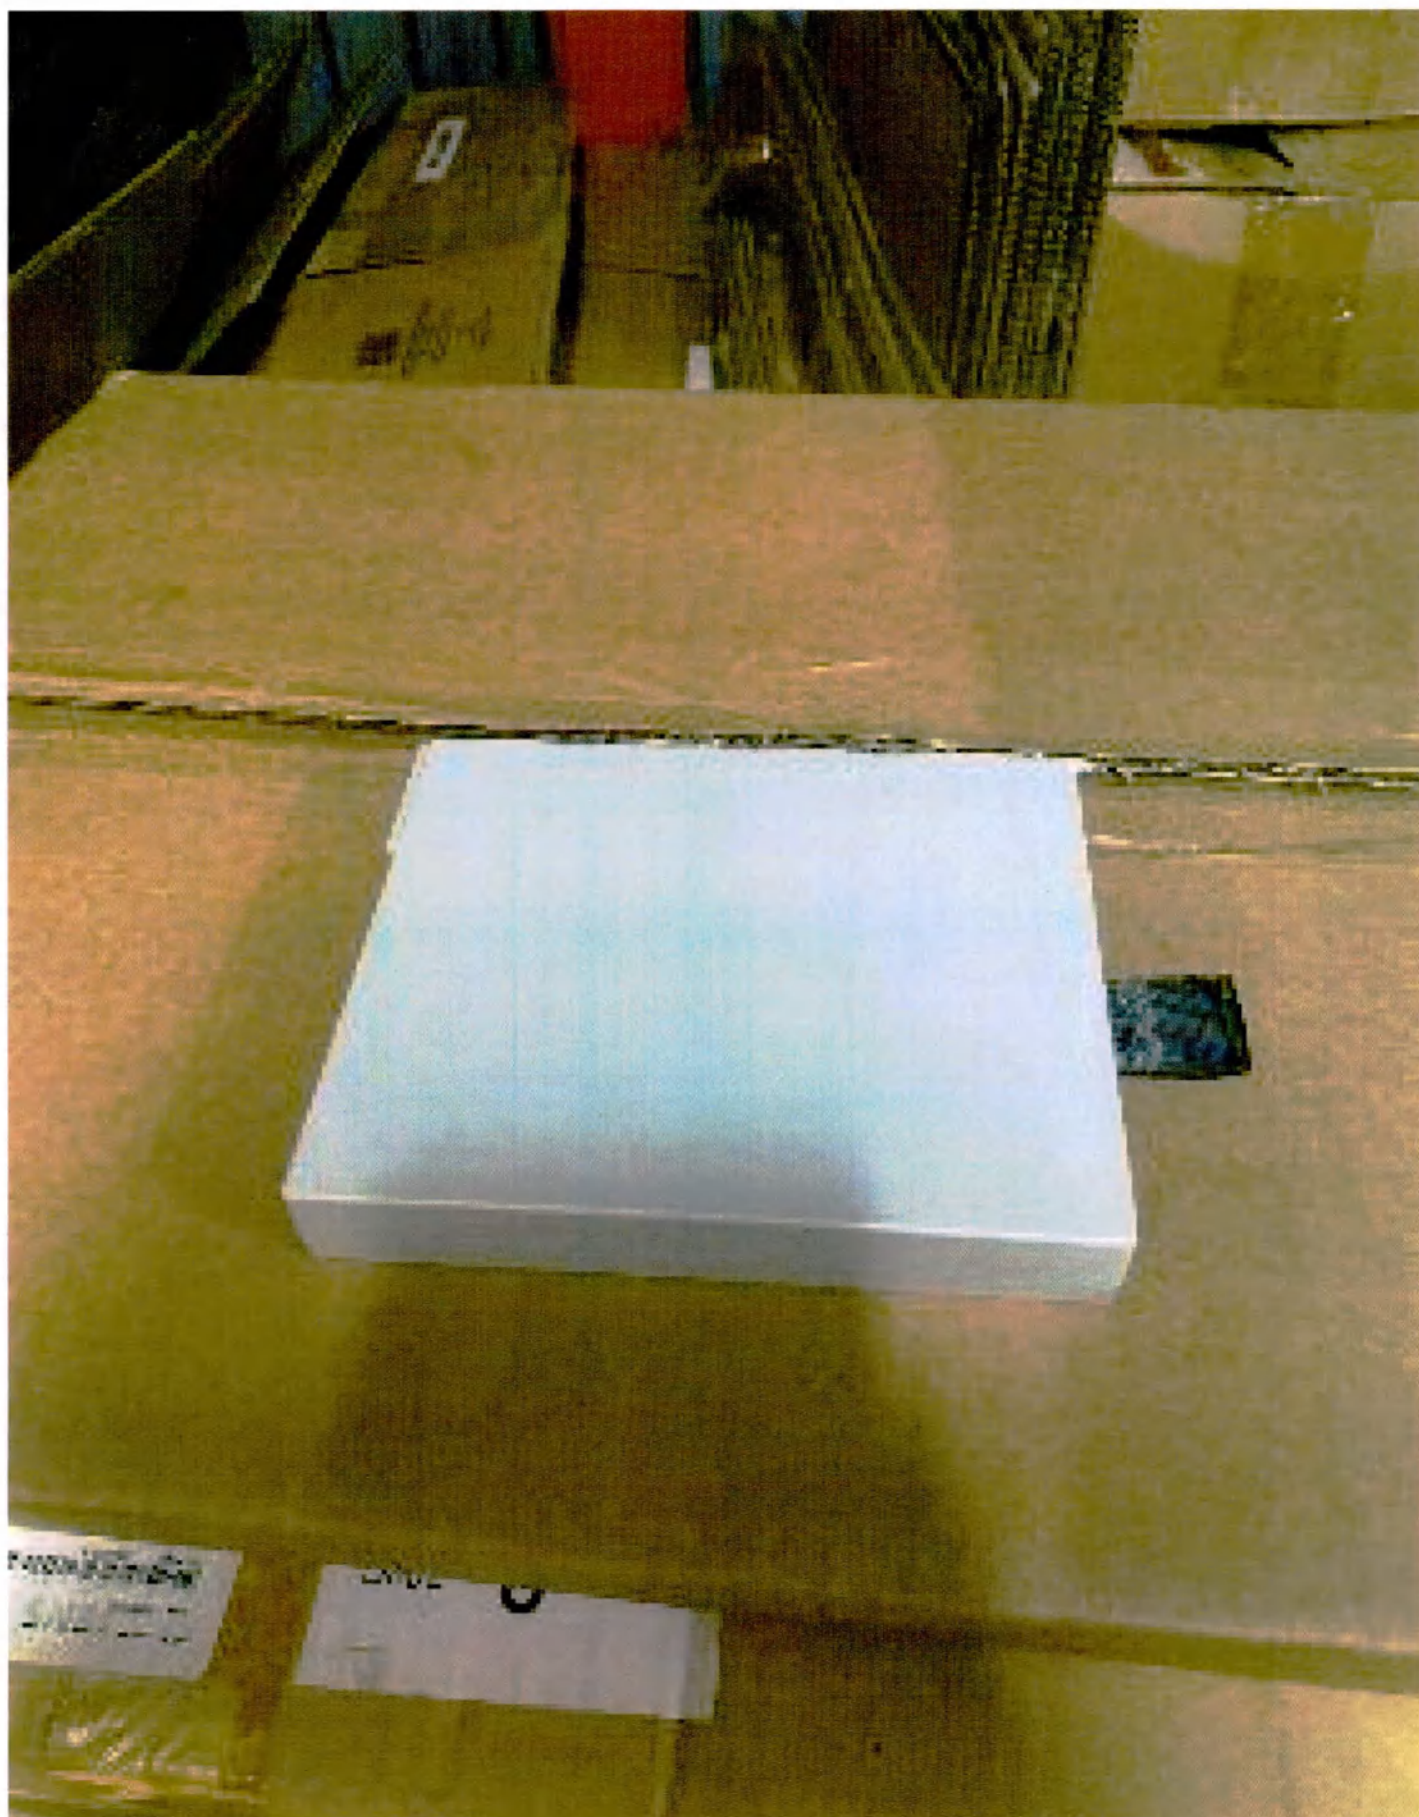

27. Литий- ионный аккумулятор – не более 5 шт. (при необходимости).



28. Ванночка для дезинфекции чреспищеводных датчиков – не более 5 шт. (при необходимости).



Руководство
пользователя

Русский

Ультразвуковые системы серии 5000 Compact

PHILIPS

29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1

Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



Руководство
пользователя
(интегрированное)

Русский

Package 1.1

Программное обеспечение углубленного количественного анализа QLAB

PHILIPS

29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1

Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1 Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



30. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе




30. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе

Принадлежности:



1. Переключатель ножной – 1 шт..

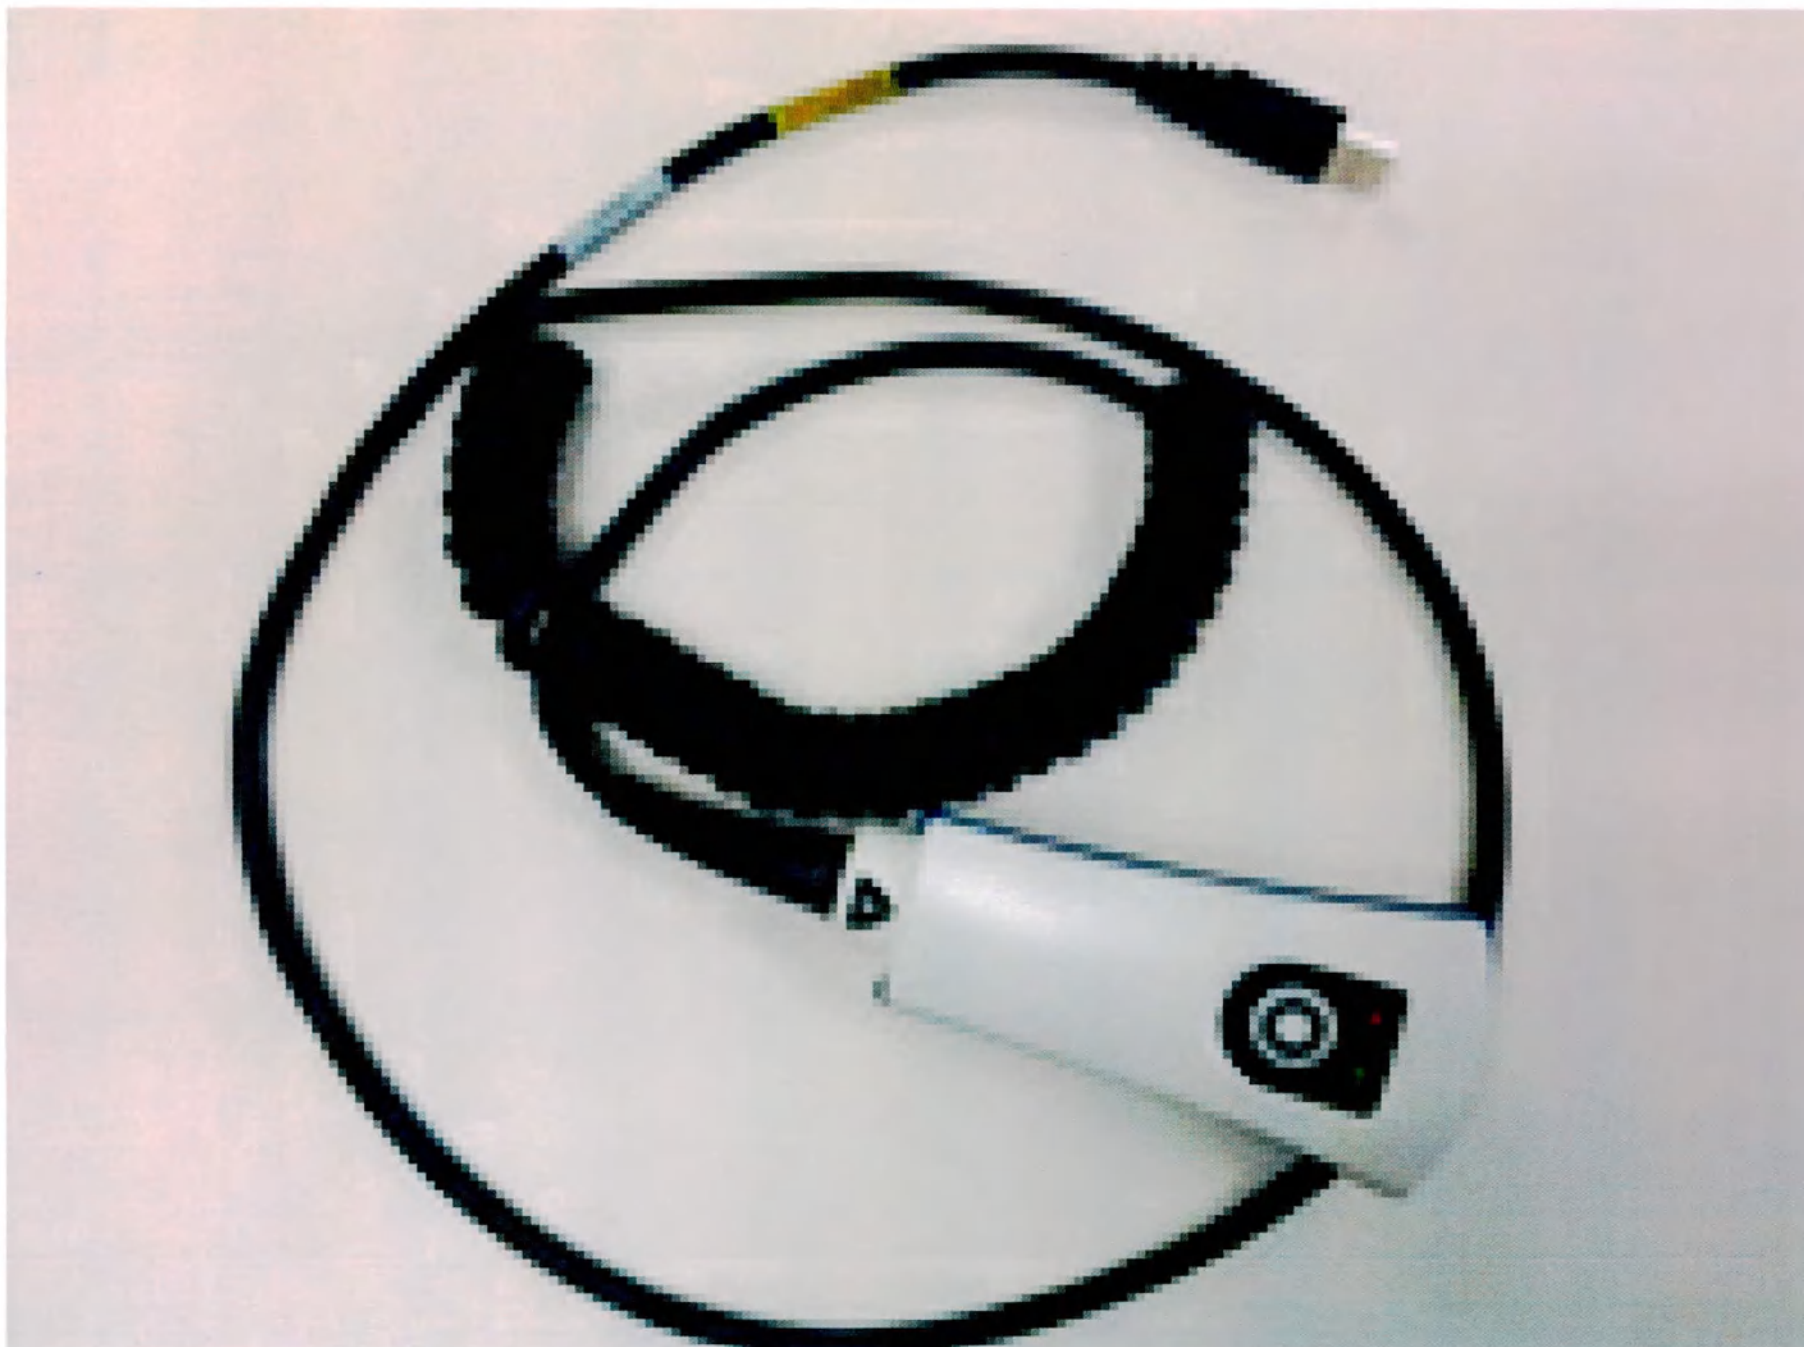

2. Сканнер штрихкода – 1 шт.



3. Кабель вывода видеосигнала – не более 5 шт.



4. Кабель ЛС сетевой – не более 5 шт.



5. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D898MD, производства компании Sony – не более 5 шт



6. Органайзер для кабелей датчиков – 2 шт.



7. Захваты кабелей – 2 шт.



8. Отсек для хранения – 1 шт.


II. Система ультразвуковая серии 5000 Compact с принадлежностями вариант исполнения 5500, в составе:




1. Блок основной ультразвуковой системы, в вариантах исполнения: 1.1. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5500G – 1 шт., или 1.2. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5500P – 1 шт., или 1.3. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5500W – 1 шт.;




2. Тележка, варианты исполнения: 2.1. Тележка Standard – 1 шт. (при необходимости); 2.2. Тележка Extended – 1 шт. (при необходимости); 2.3. Тележка Deluxe – 1 шт. (при необходимости); 2.4. Тележка Premium с полкой для принтера – 1 шт. (при необходимости).

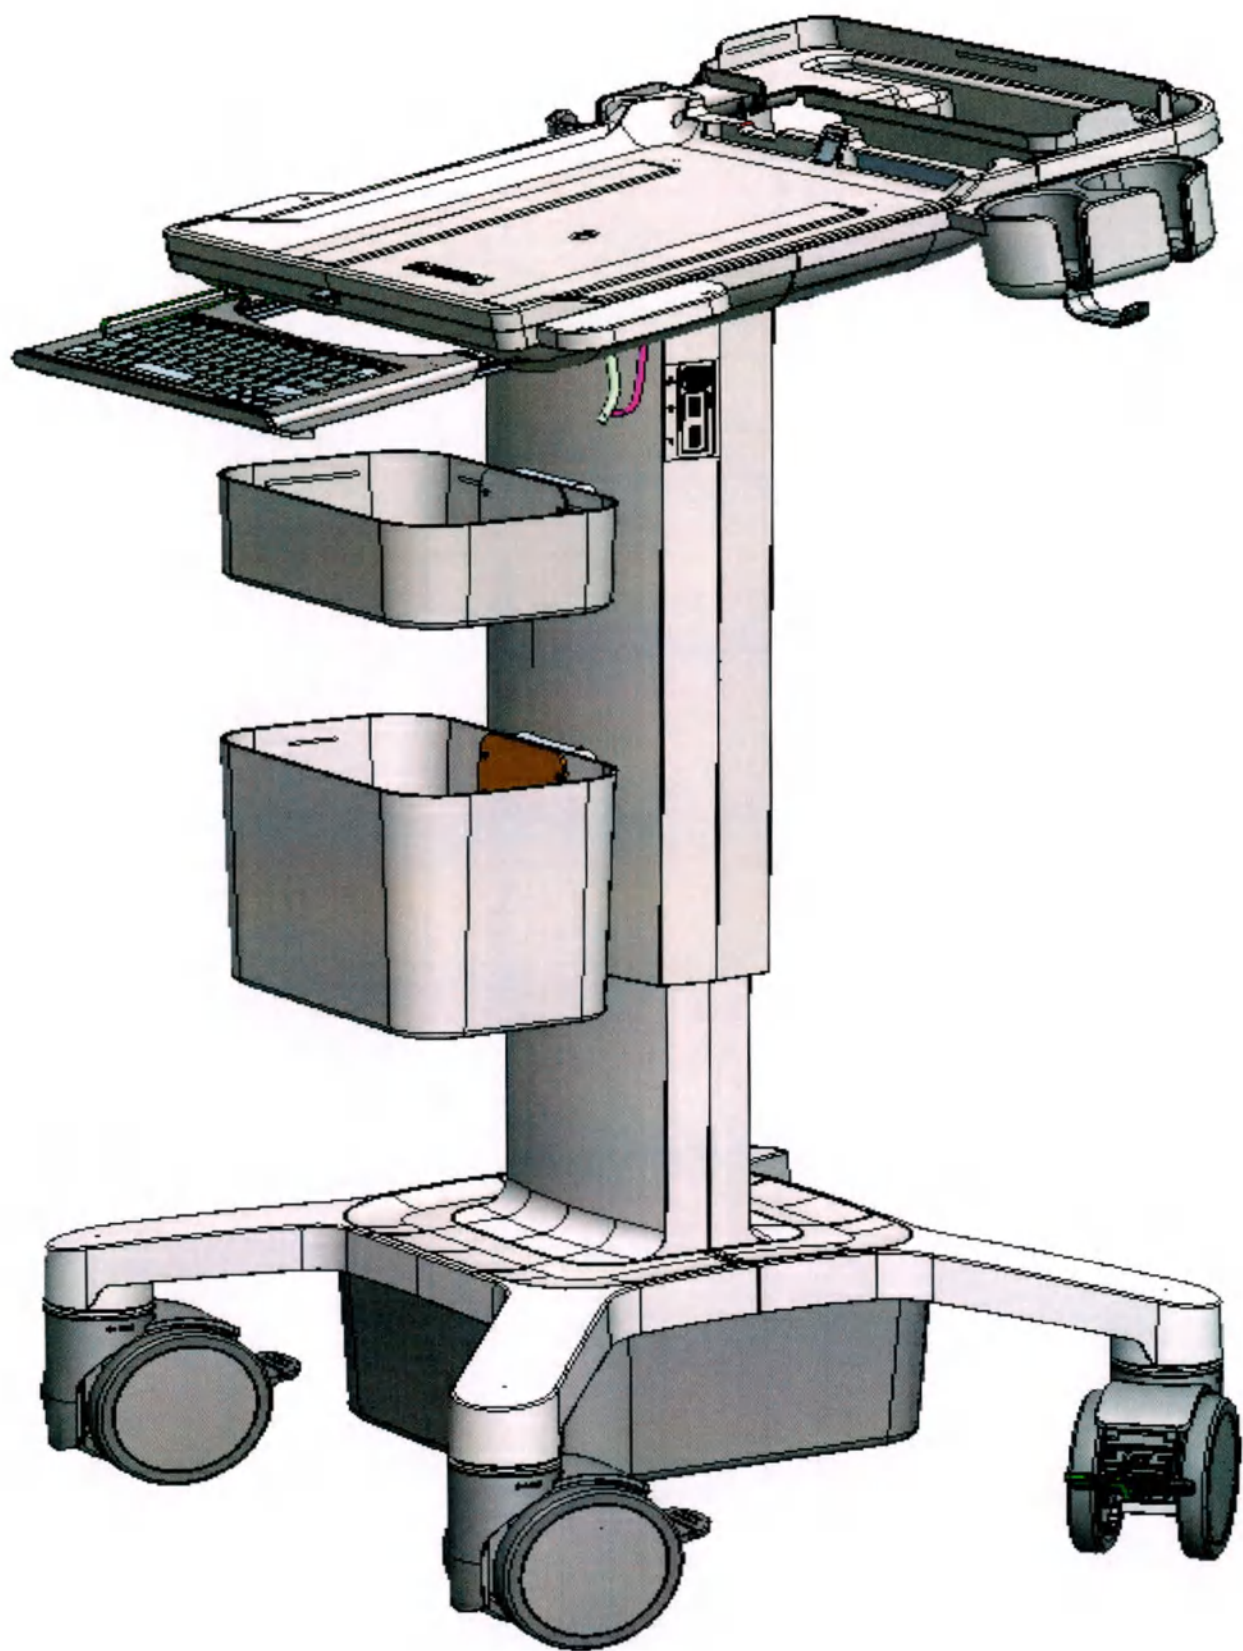


2.1. Тележка Standard – 1 шт. (при необходимости);

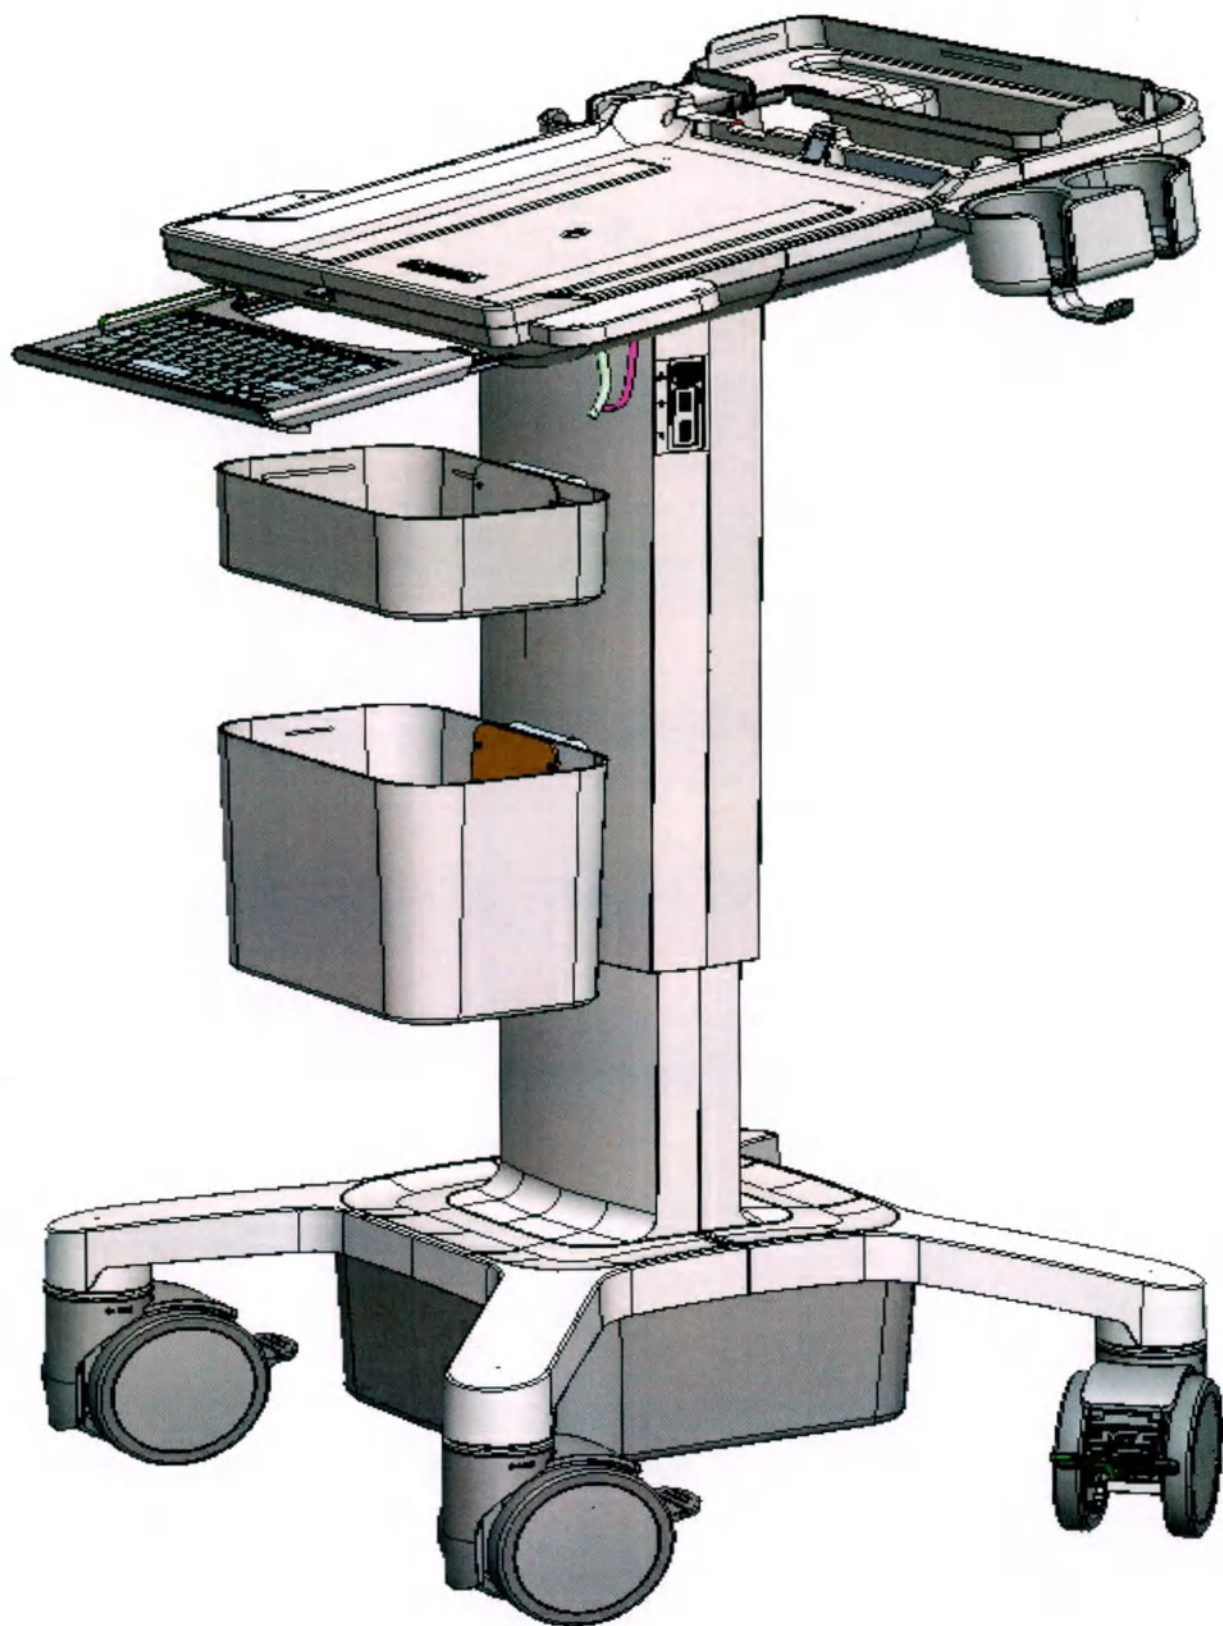


2.2. Тележка Extended – 1 шт. (при необходимости);

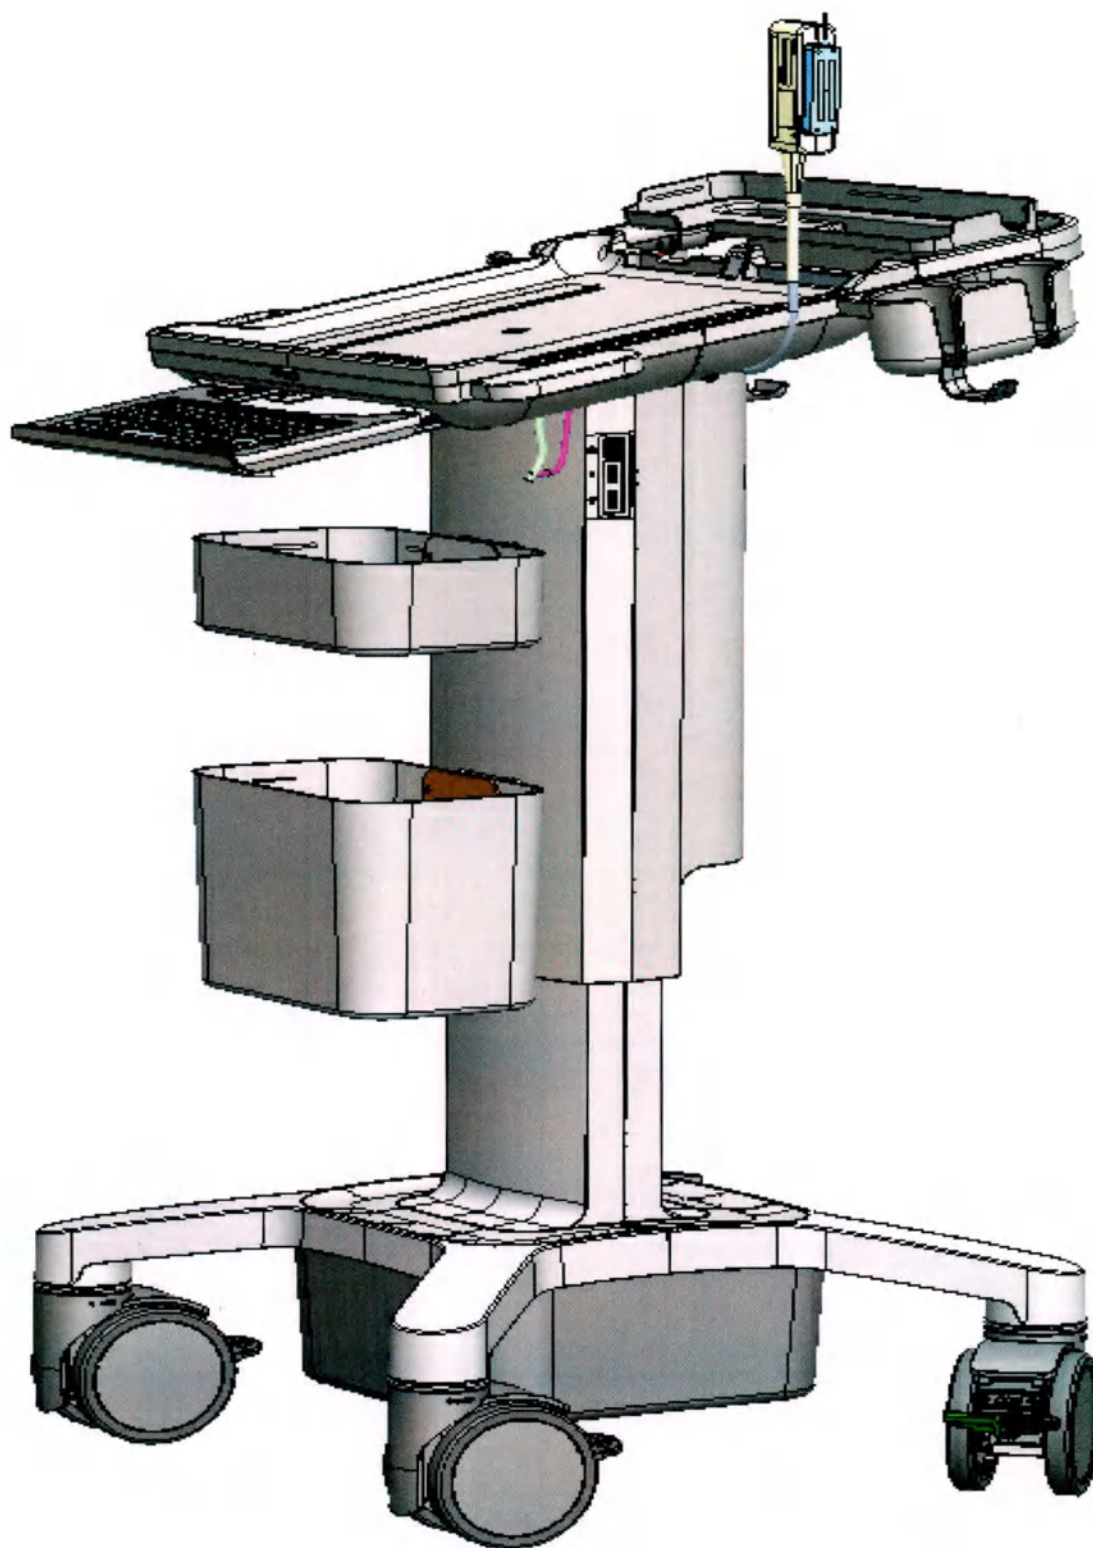

2.3. Тележка Deluxe – 1 шт. (при необходимости);

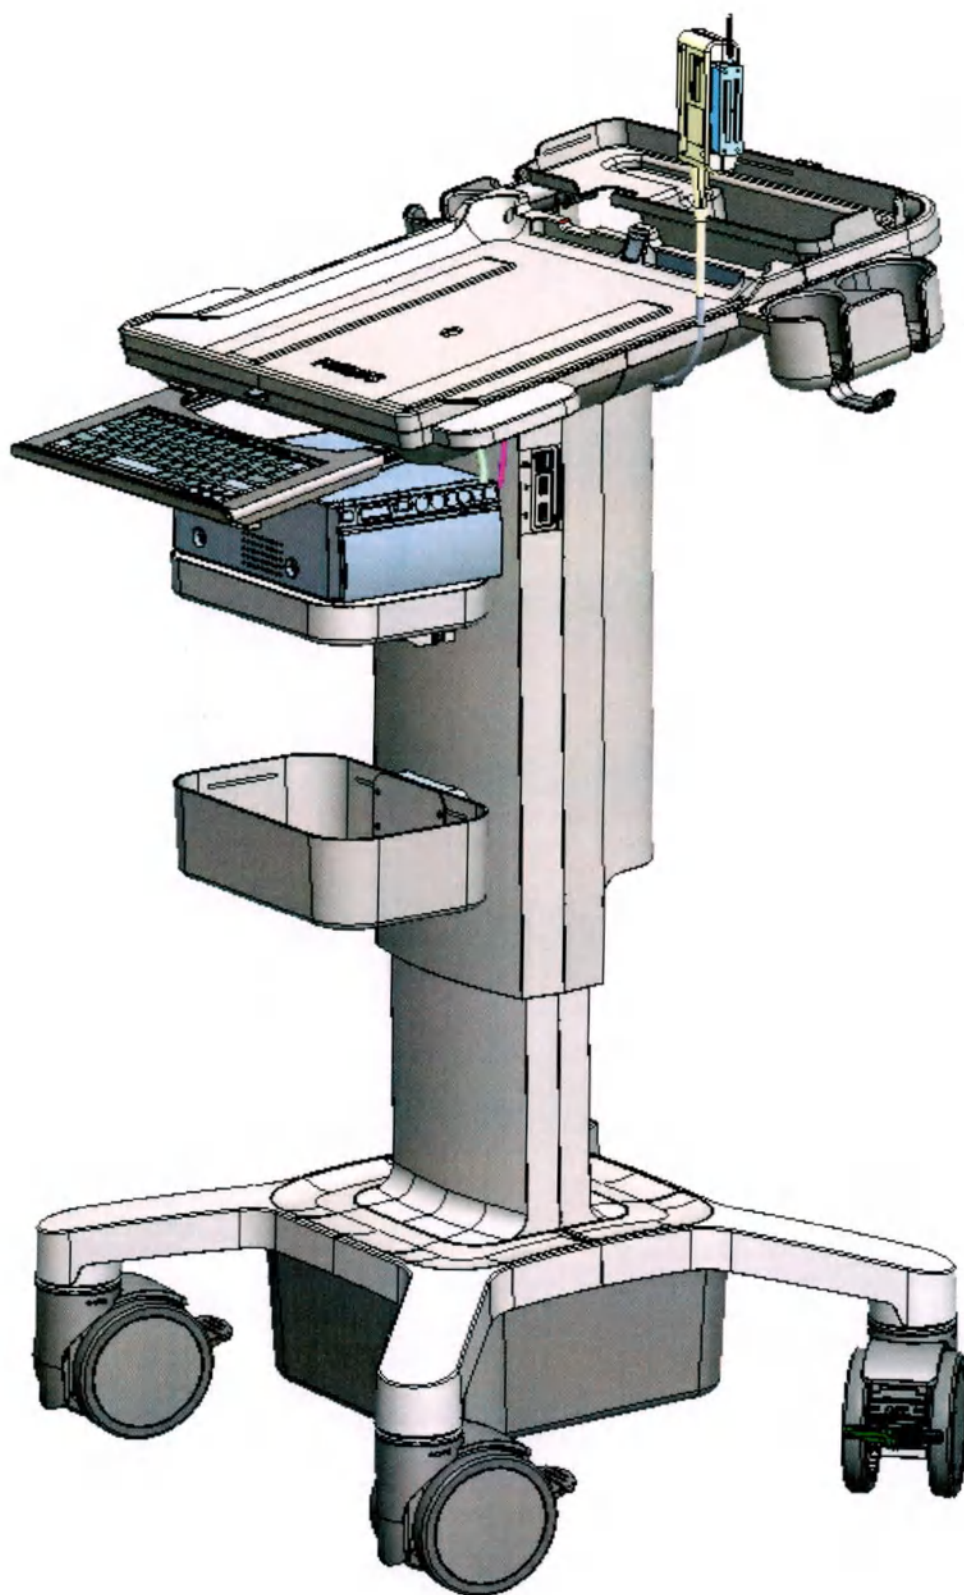

2.4. Тележка Premium с полкой для принтера– 1 шт. (при необходимости).

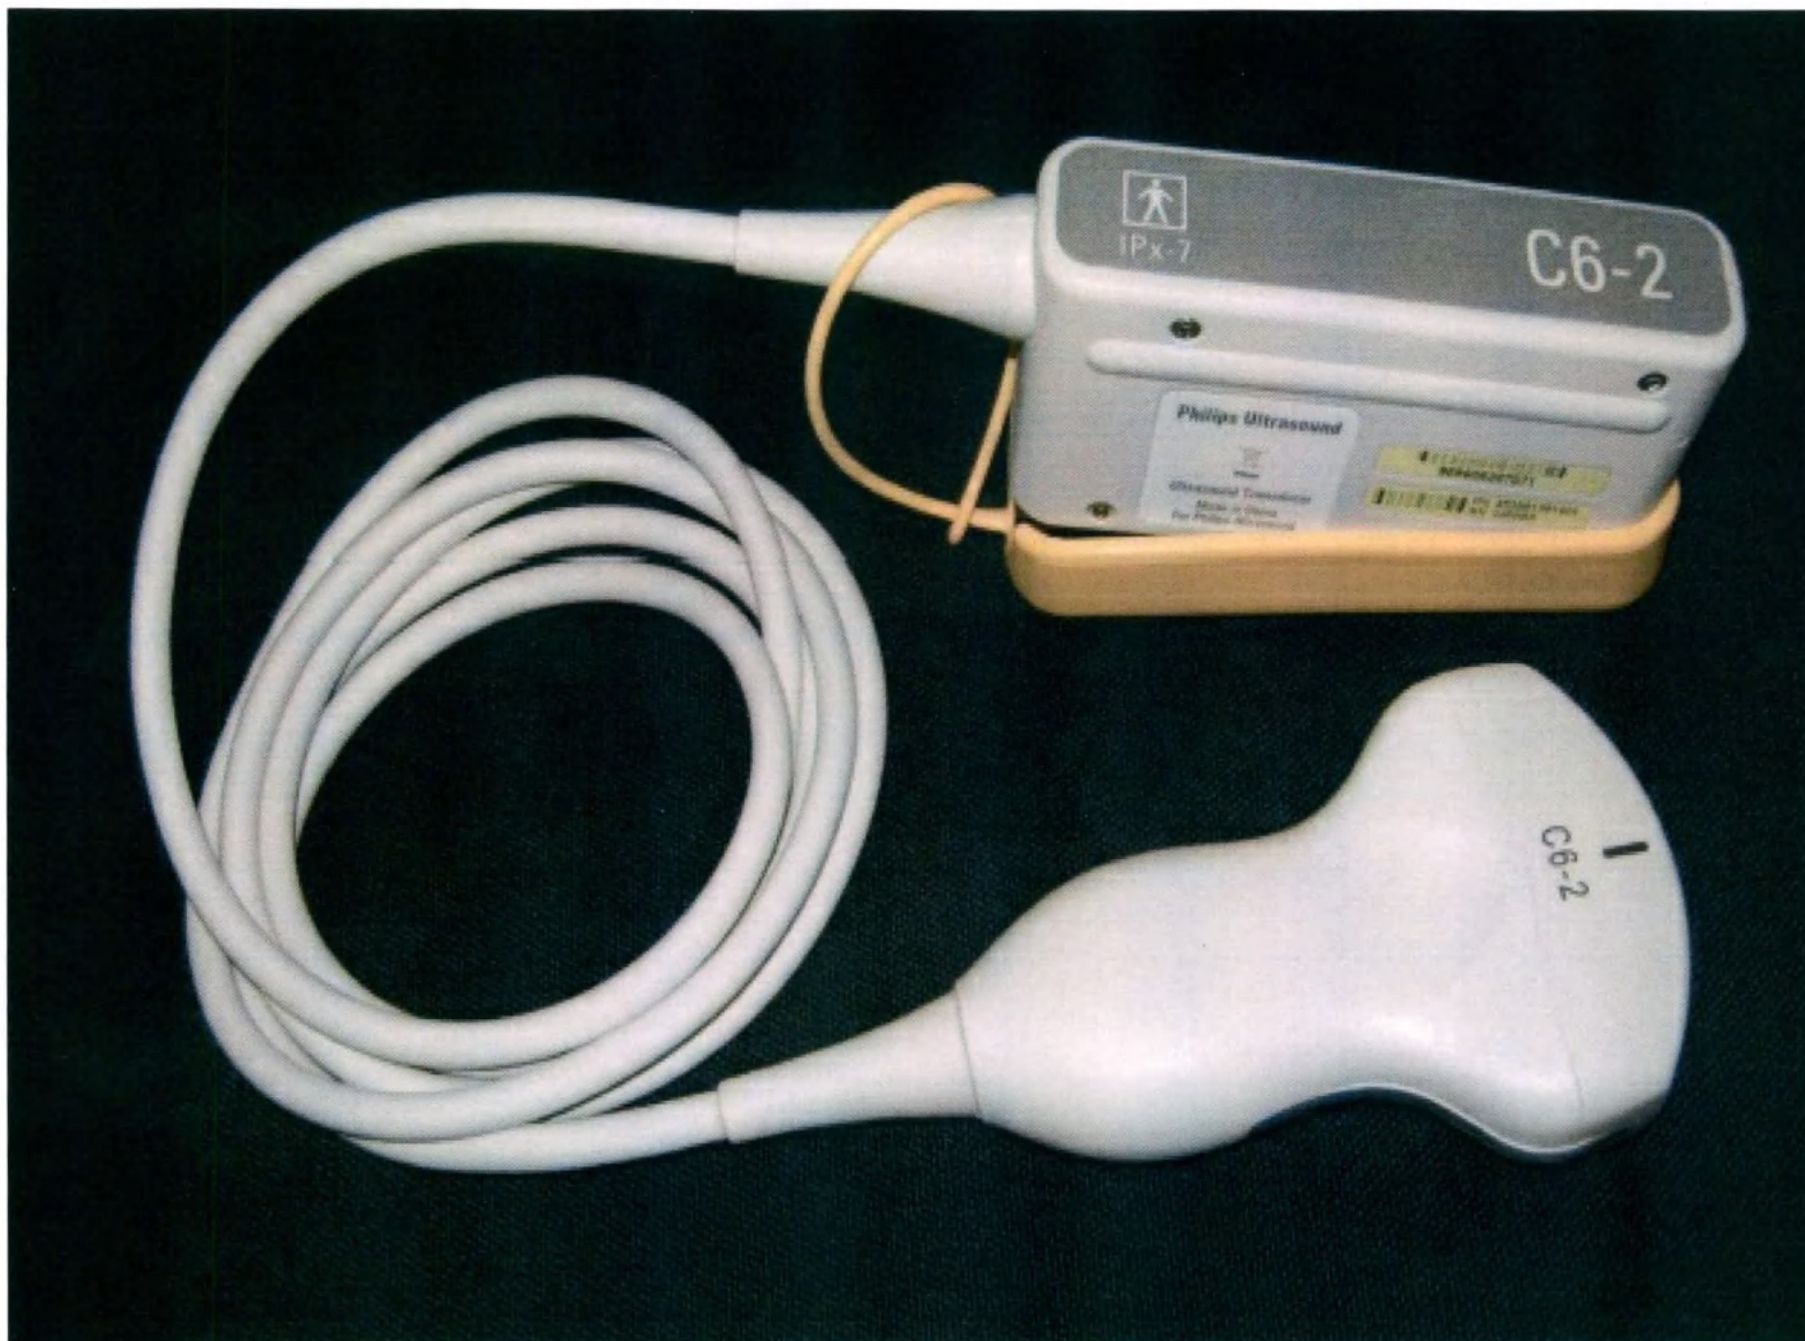

3. Датчик с конвексной матрицей C6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




4. Датчик с конвексной матрицей C8-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



5. Латчик с конвексной матрицей C5-1, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).




6. Датчик с конвексной матрицей C9-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

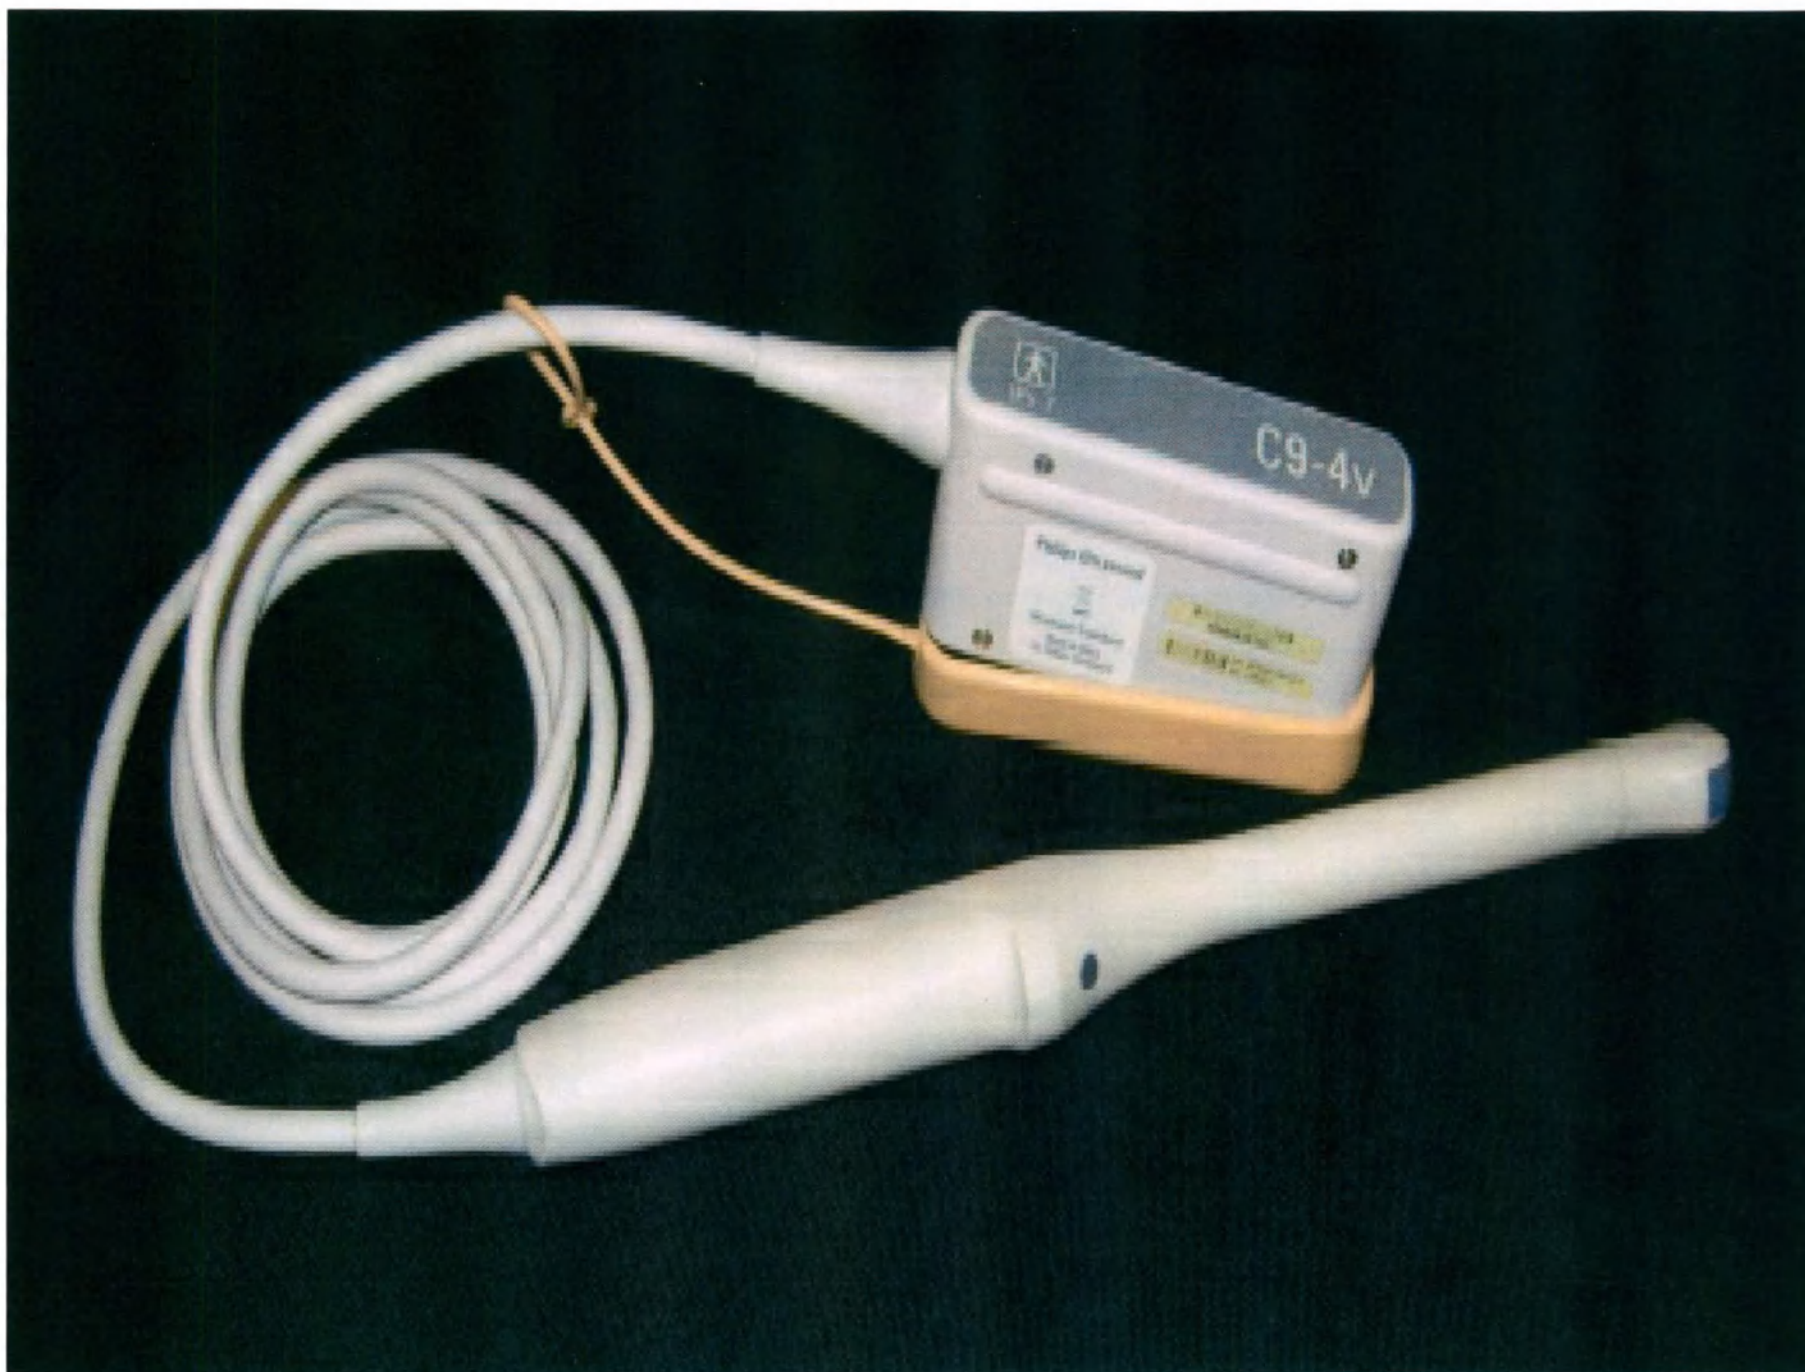


7. Датчик с конвексной матрицей C9-4v, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



8. Датчик с конвексной матрицей C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

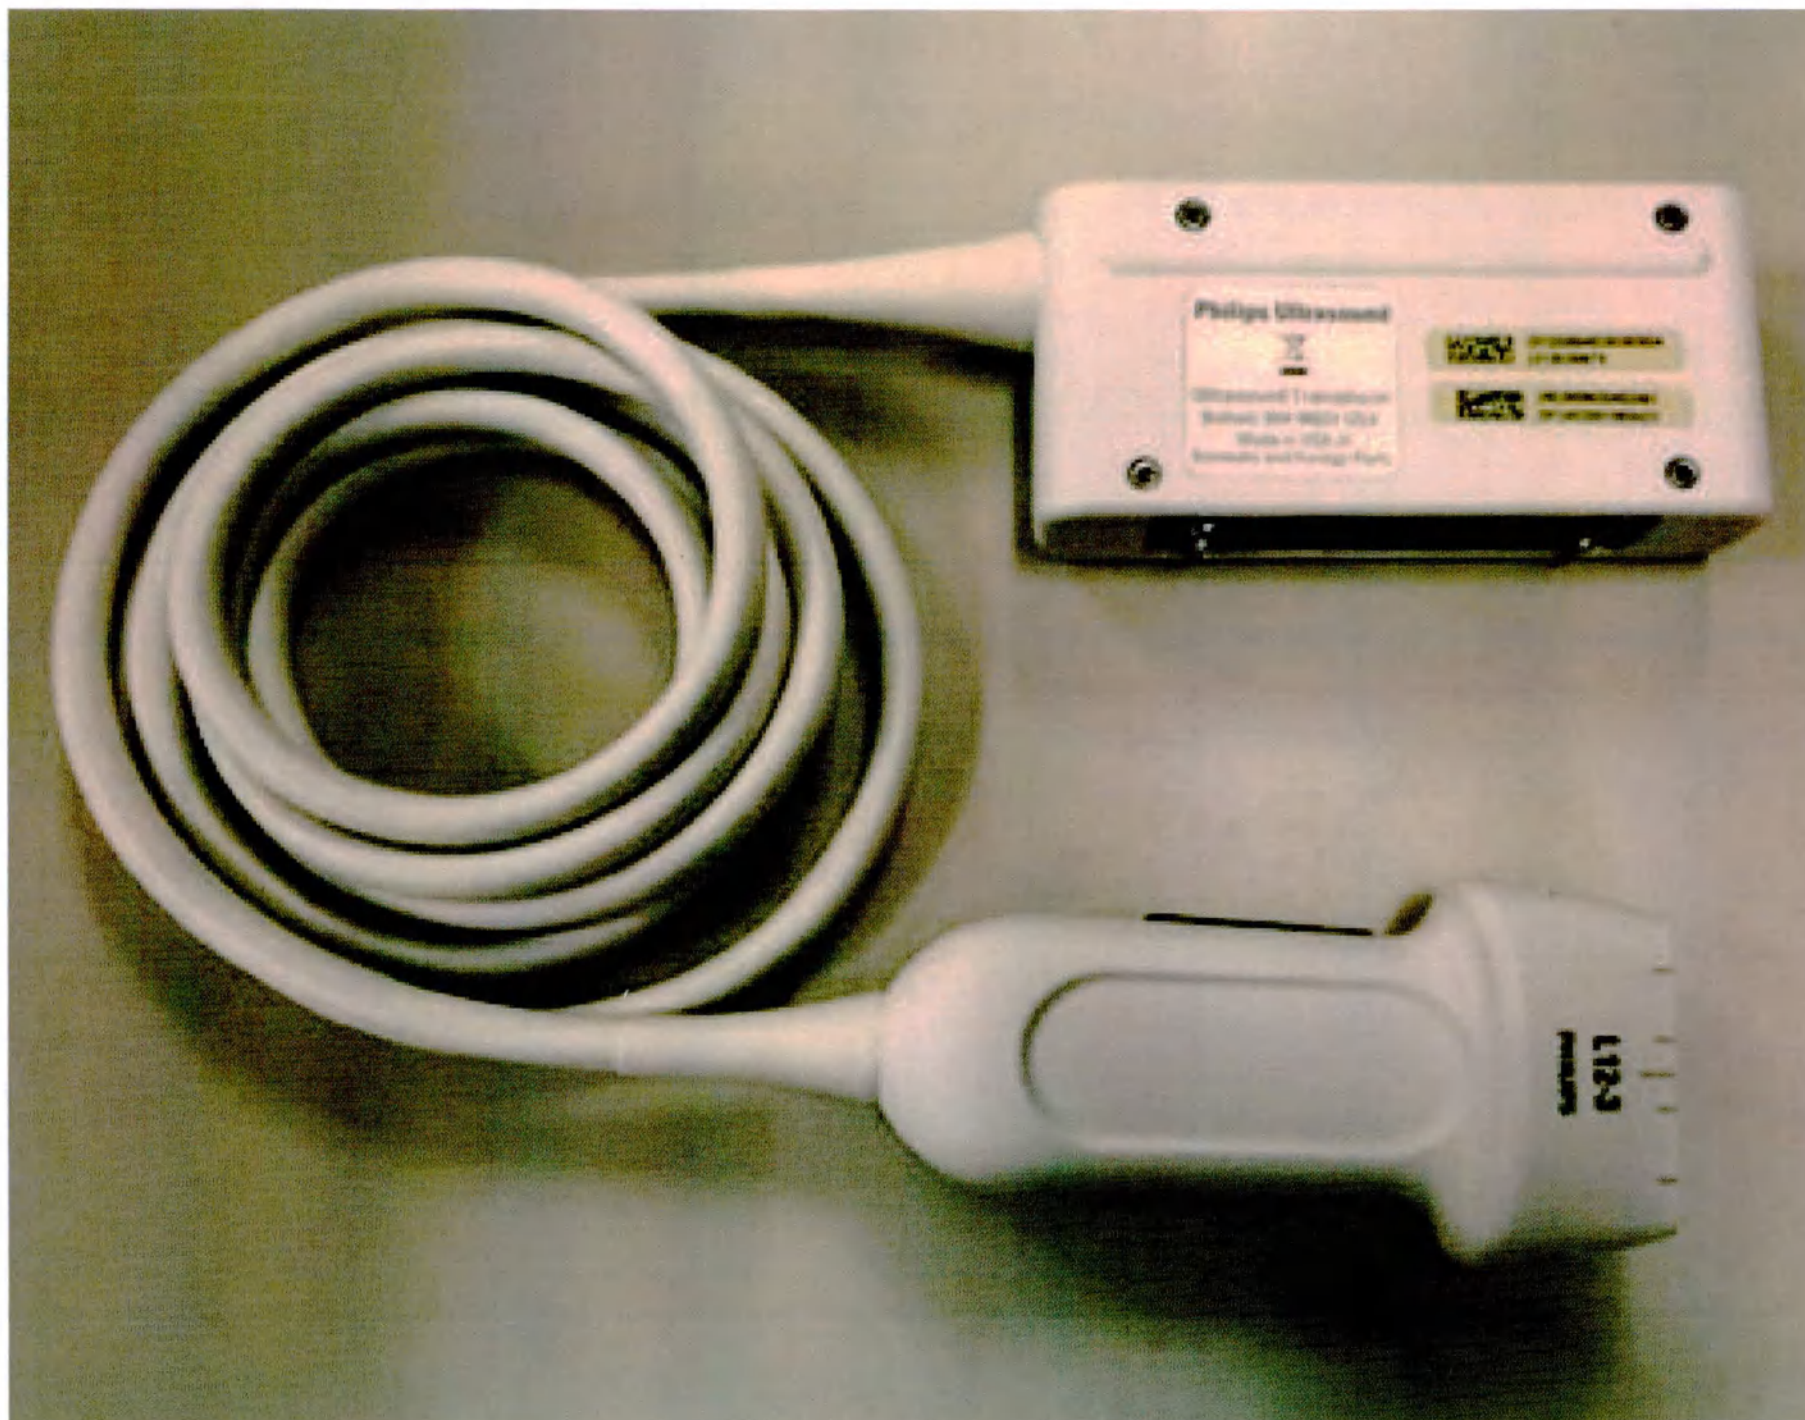

9. Датчик с линейной матрицей L12-3 ERGO, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

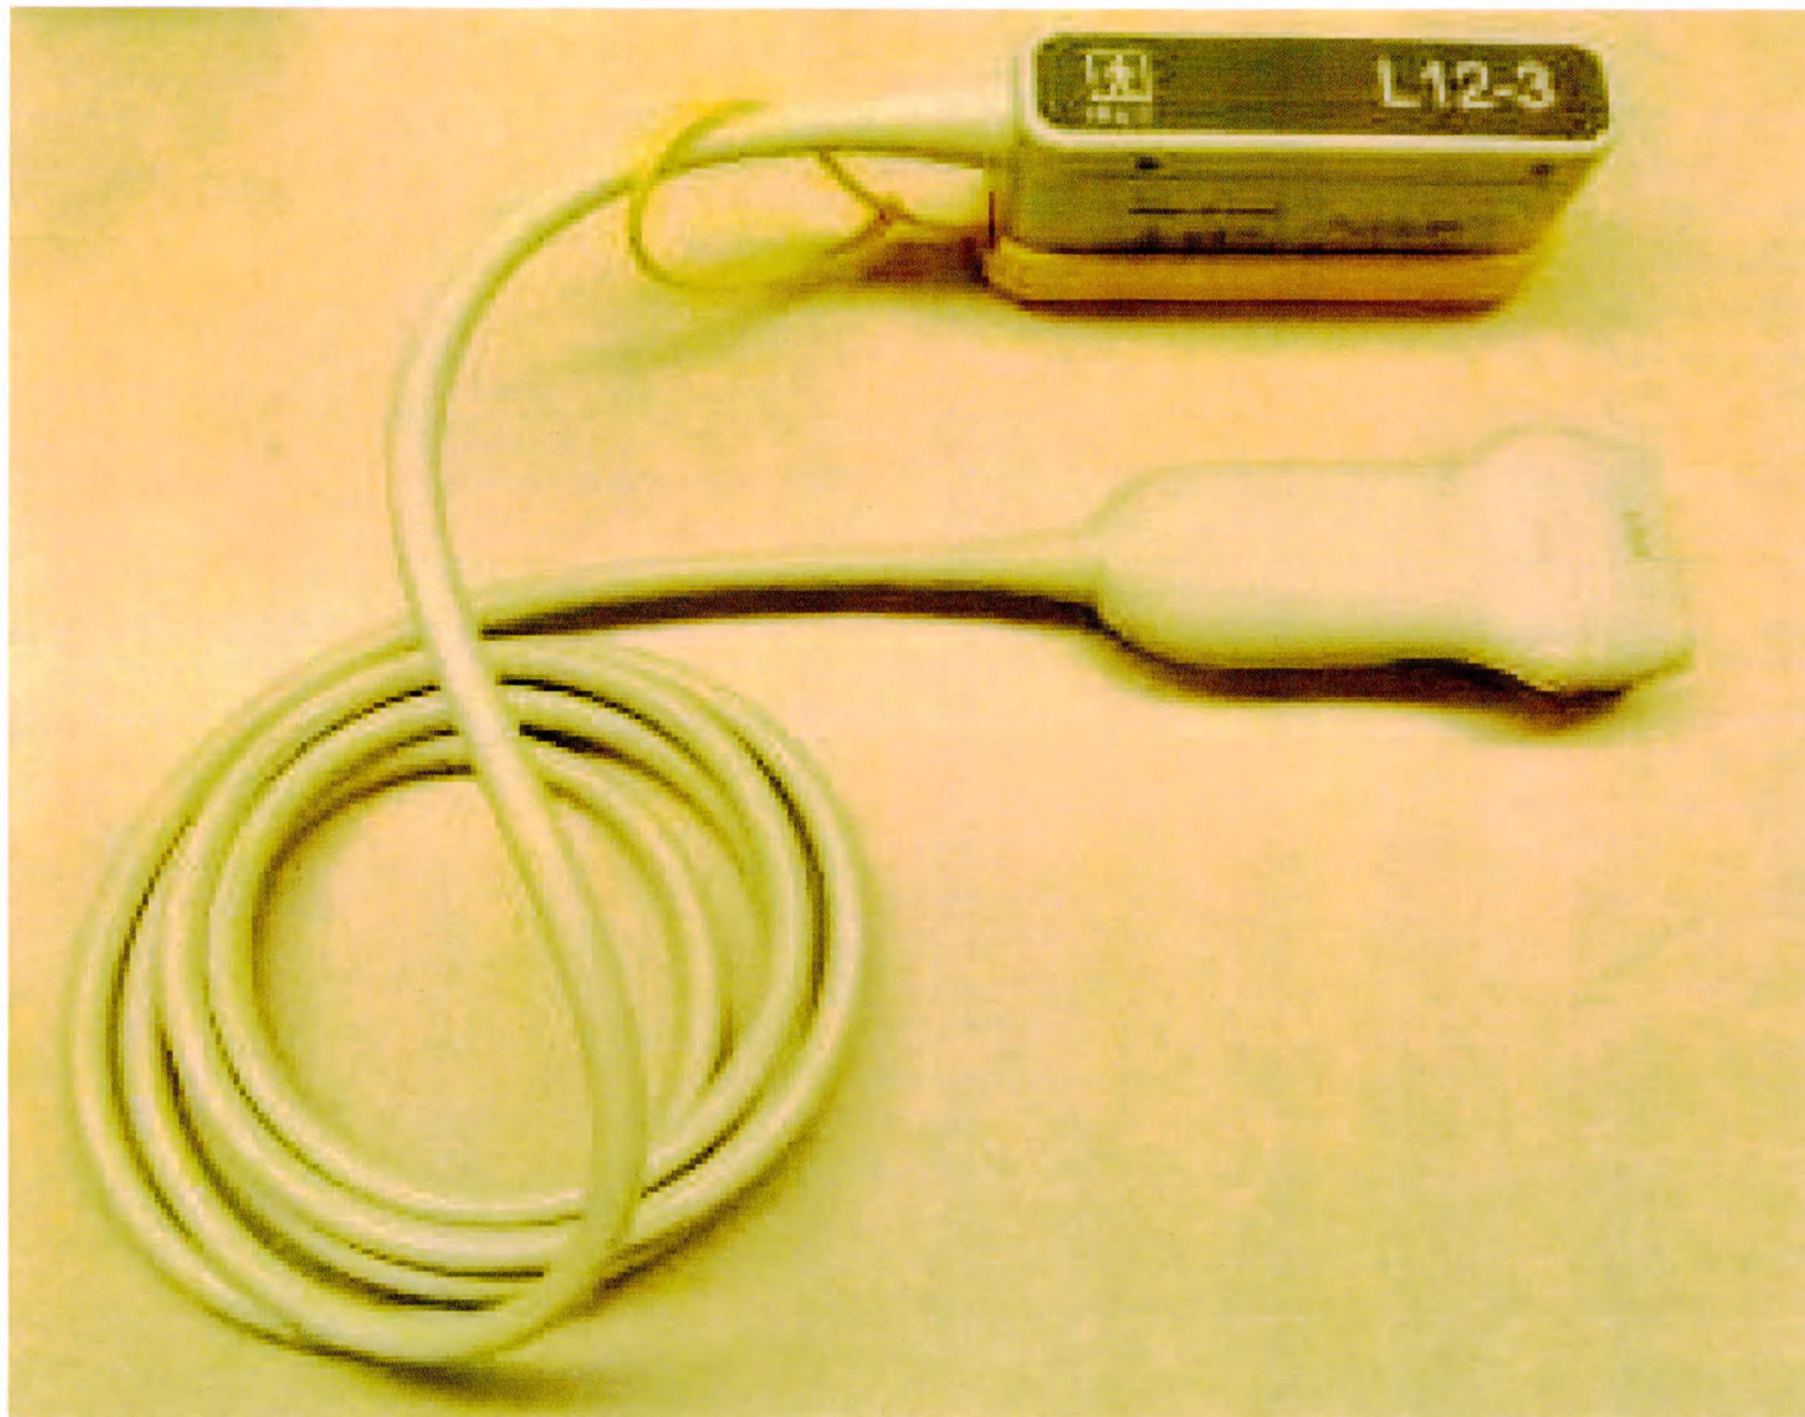

10. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;



10. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;




11. Датчик с линейной матрицей L12-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;



12. Датчик с линейной матрицей L12-5 50, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).




13. Датчик с линейной матрицей L15-7io, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

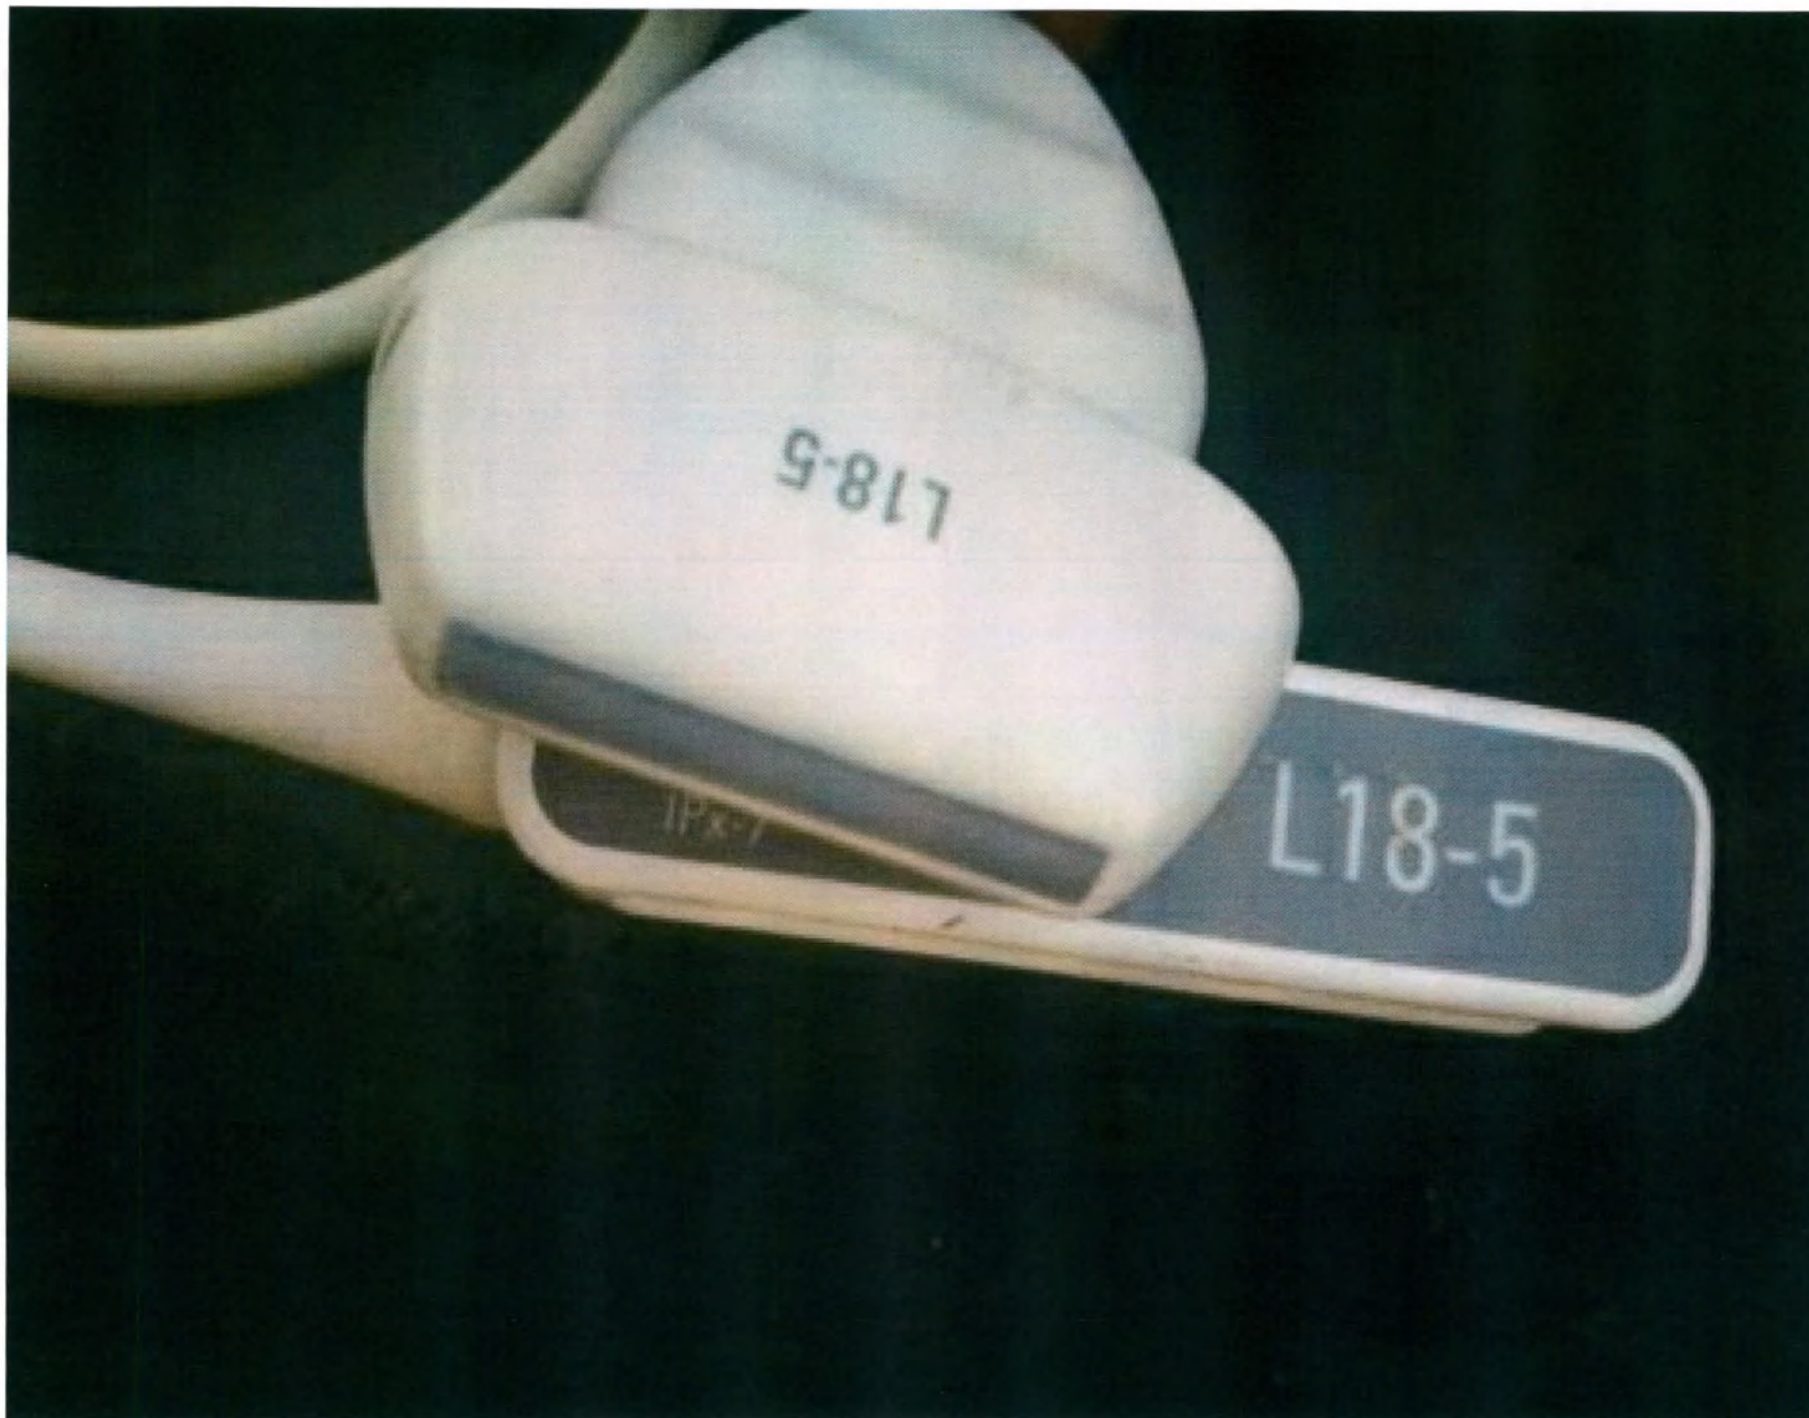

14. Датчик с линейной матрицей L18-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;




15. Датчик с линейной матрицей eL18-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

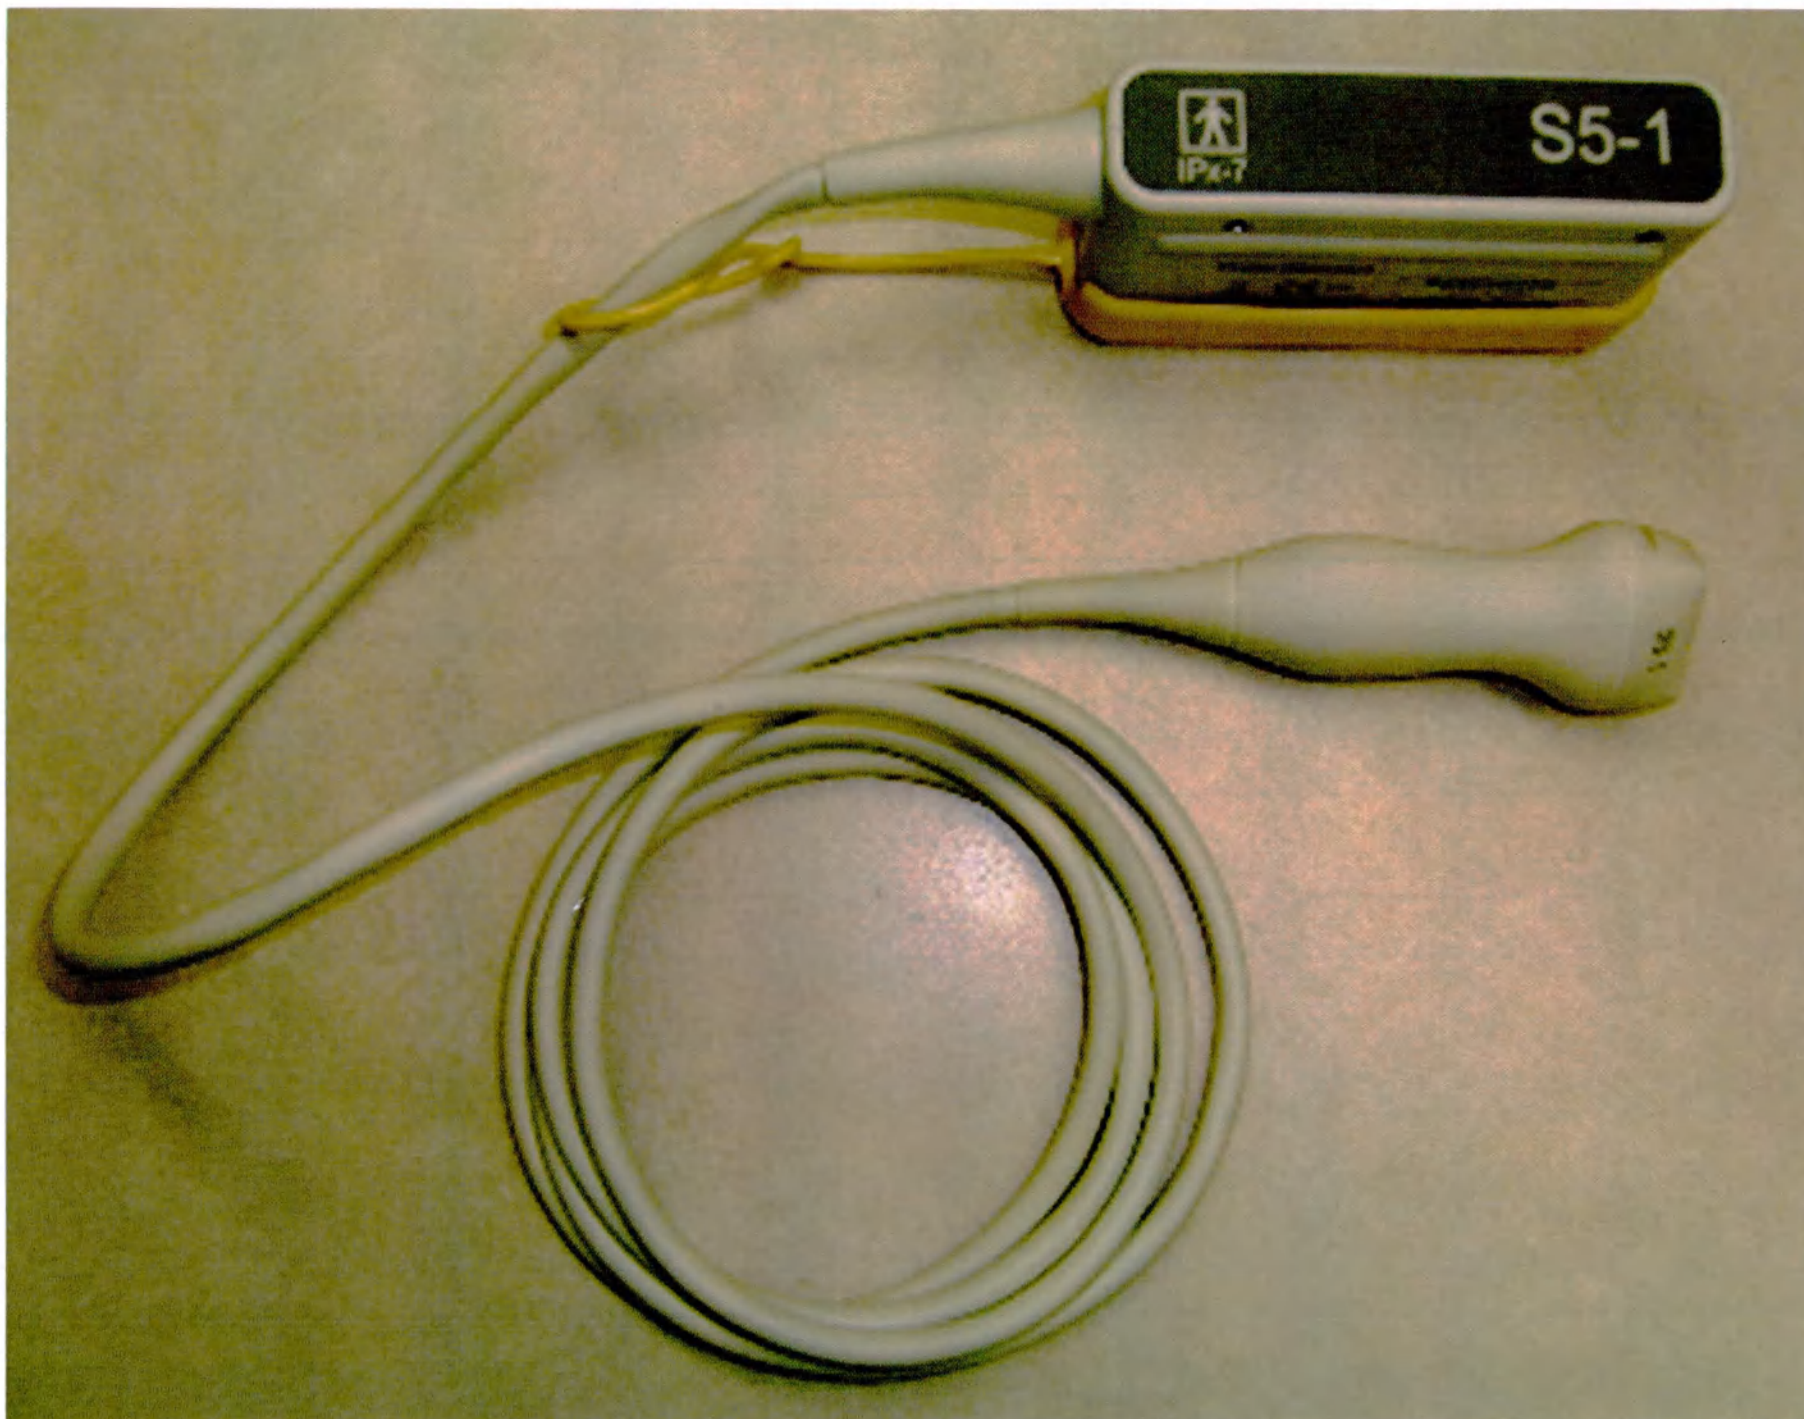

16. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S5-1, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).




17. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)

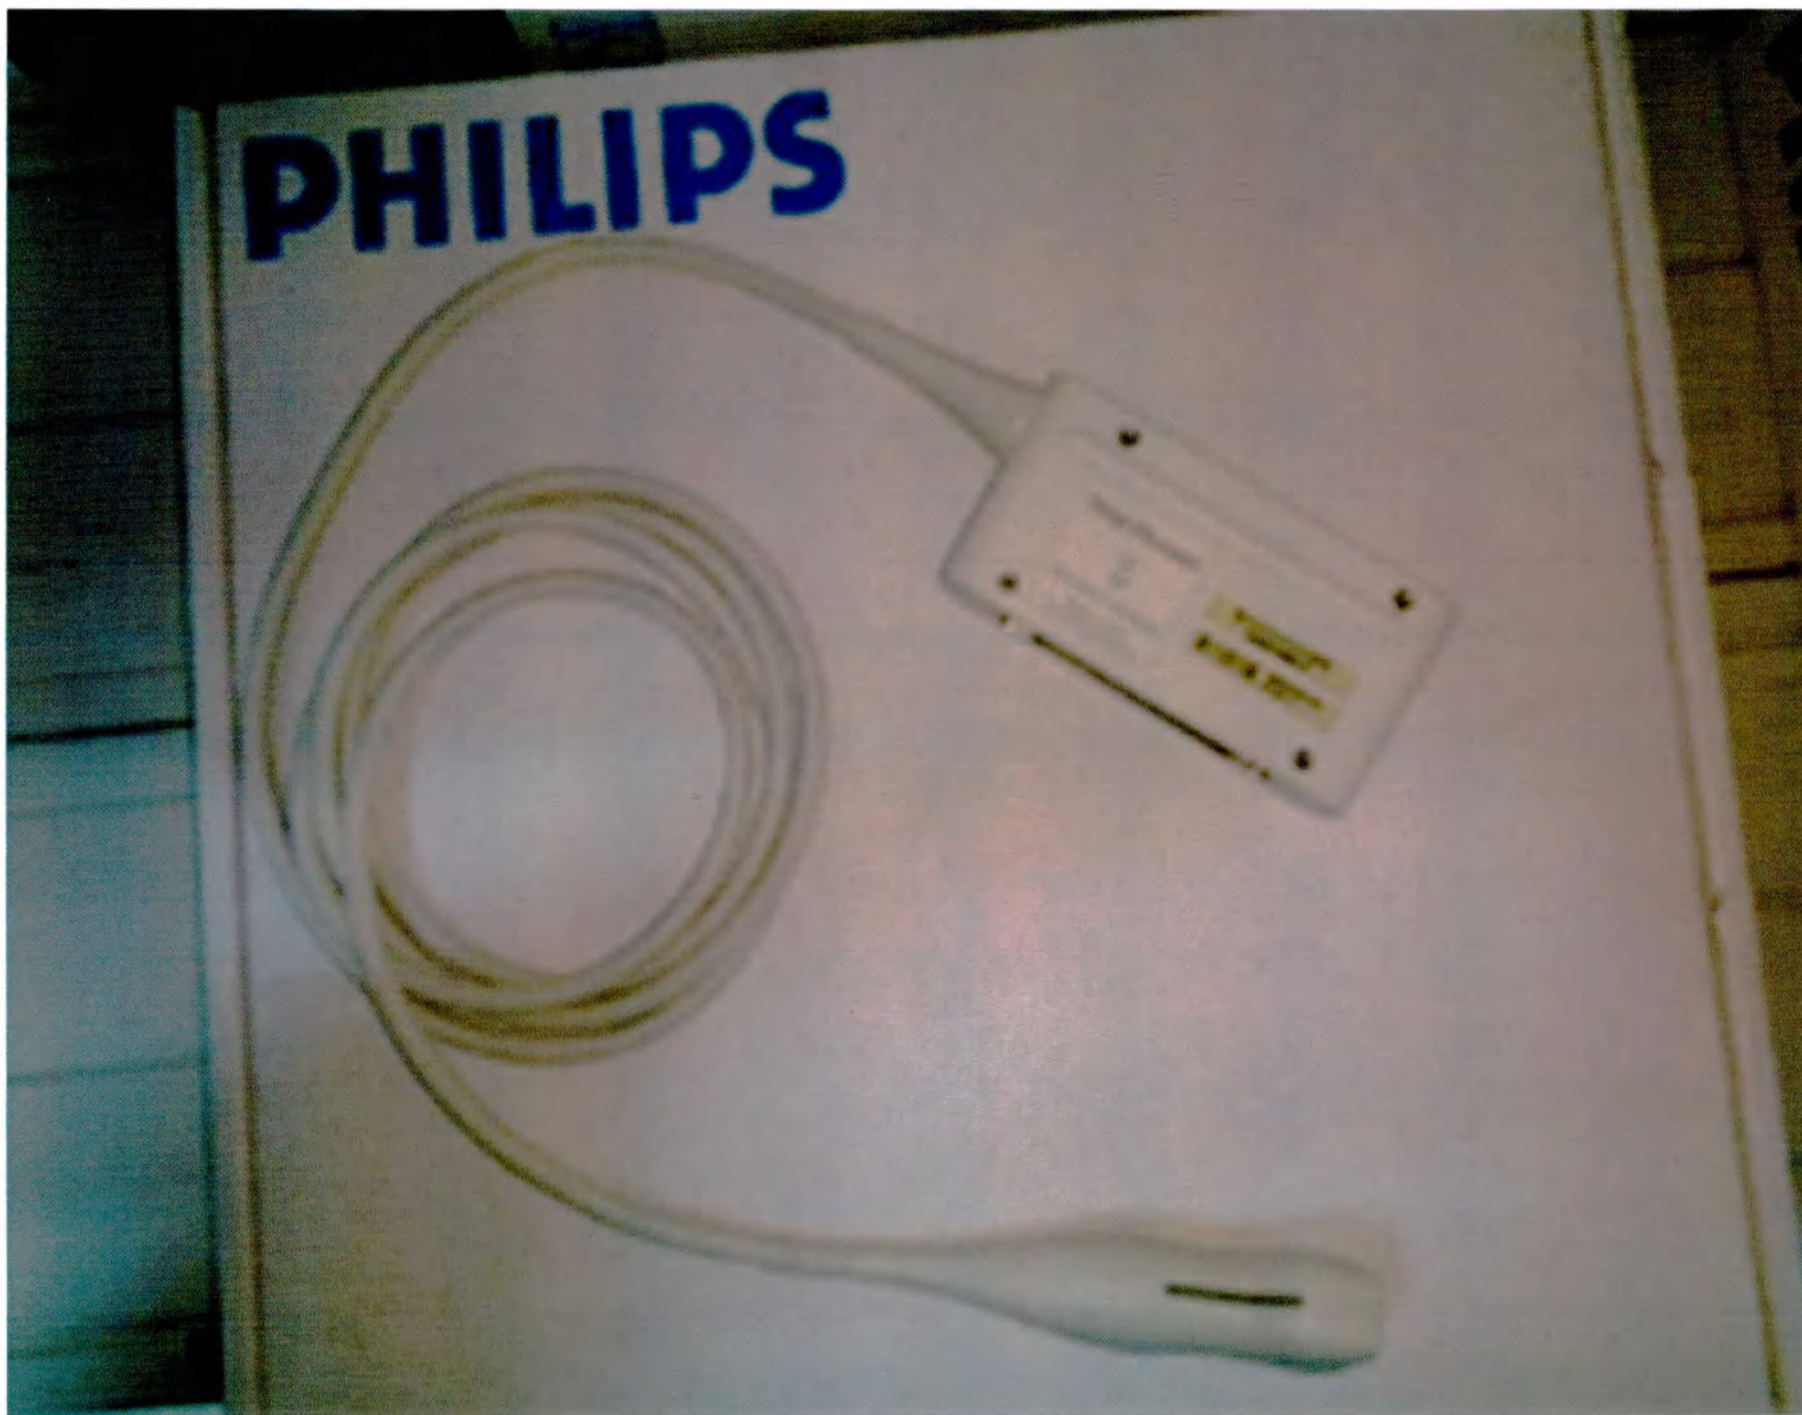


17. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)



18. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S4-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)

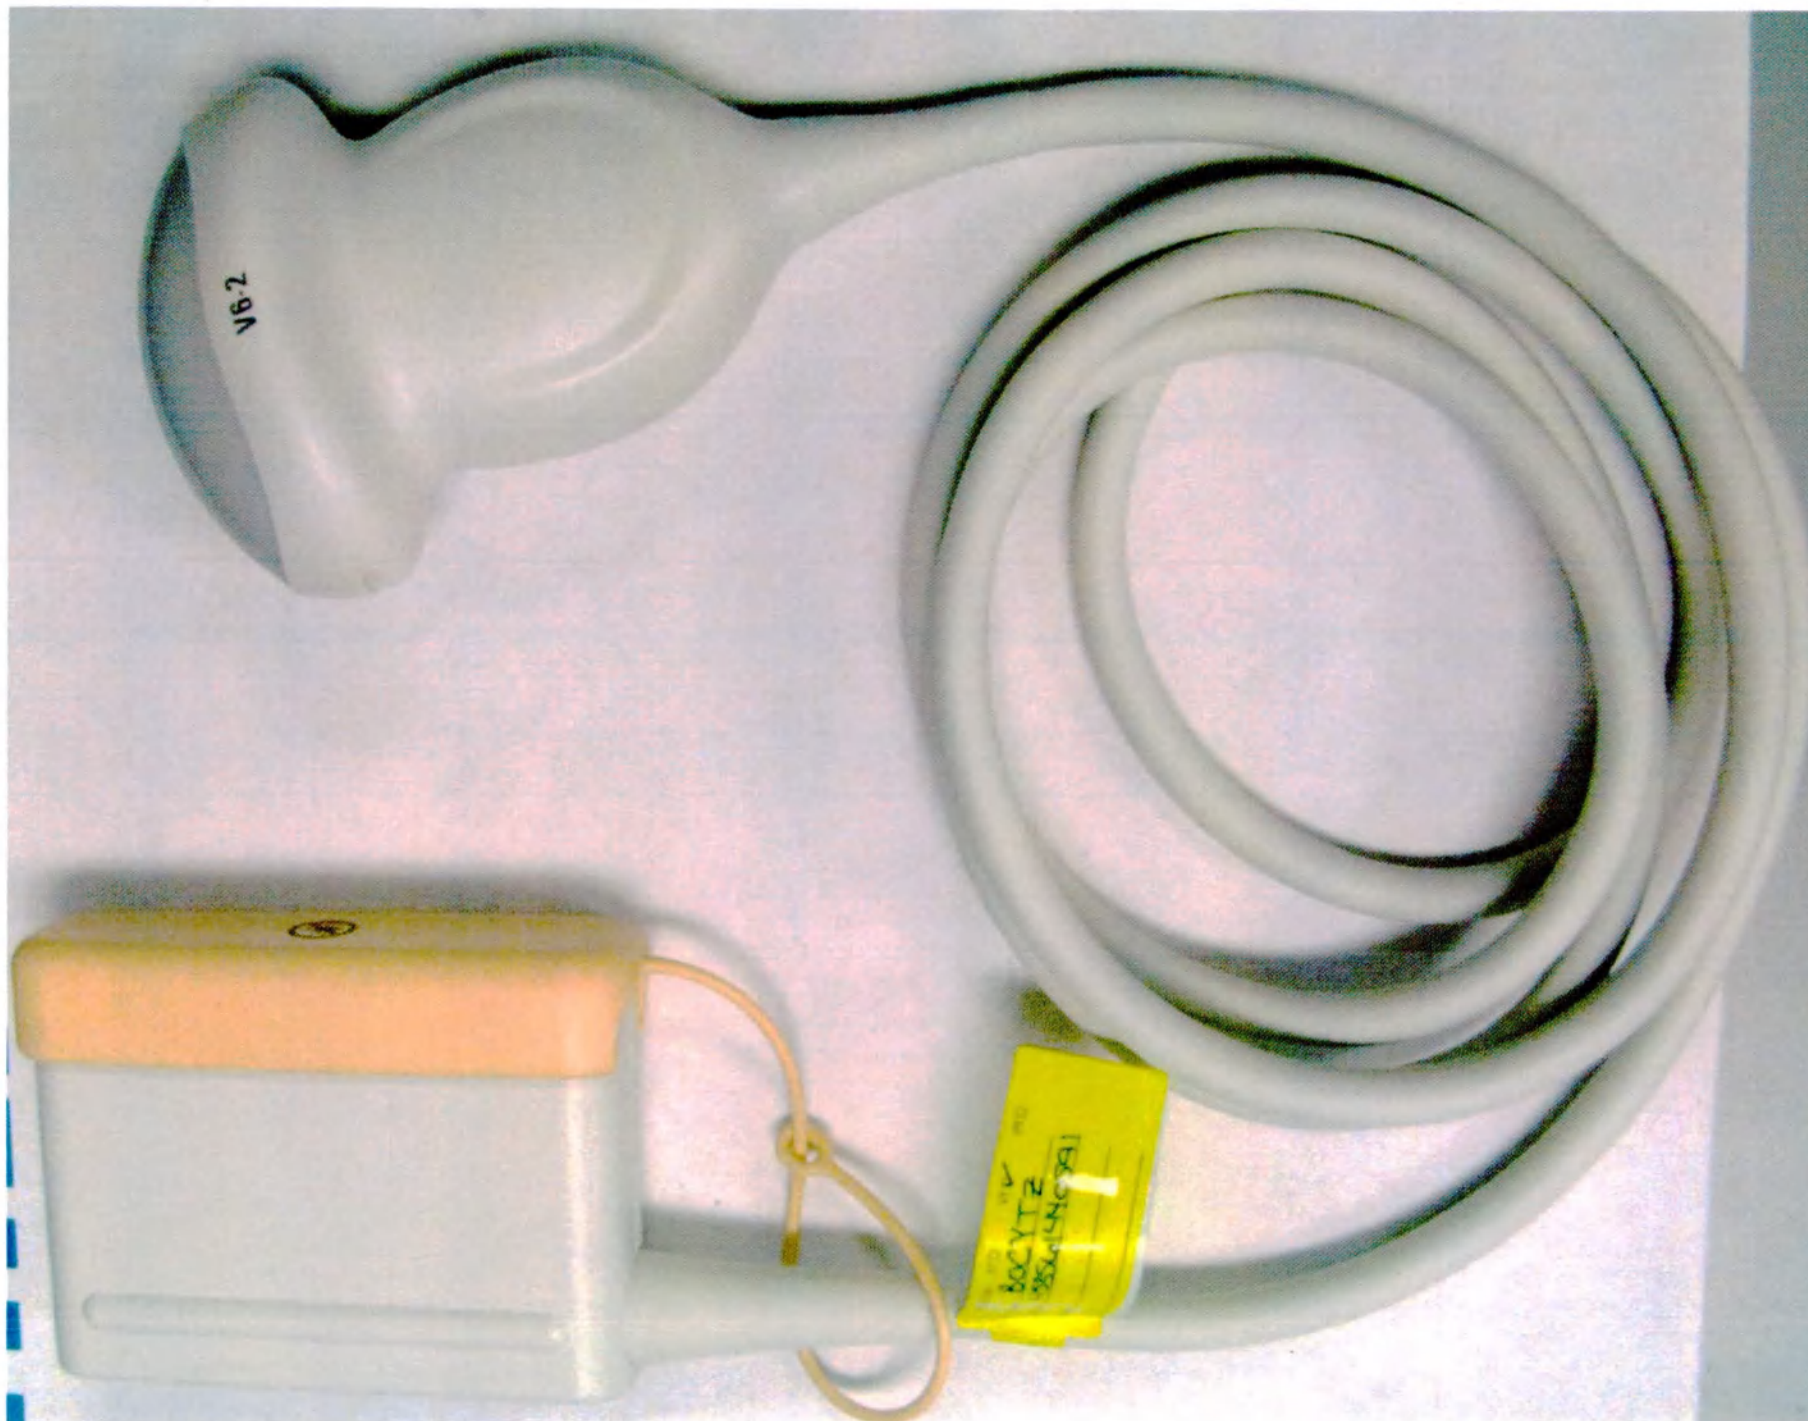


19. Датчик с конвексной матрицей V6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)

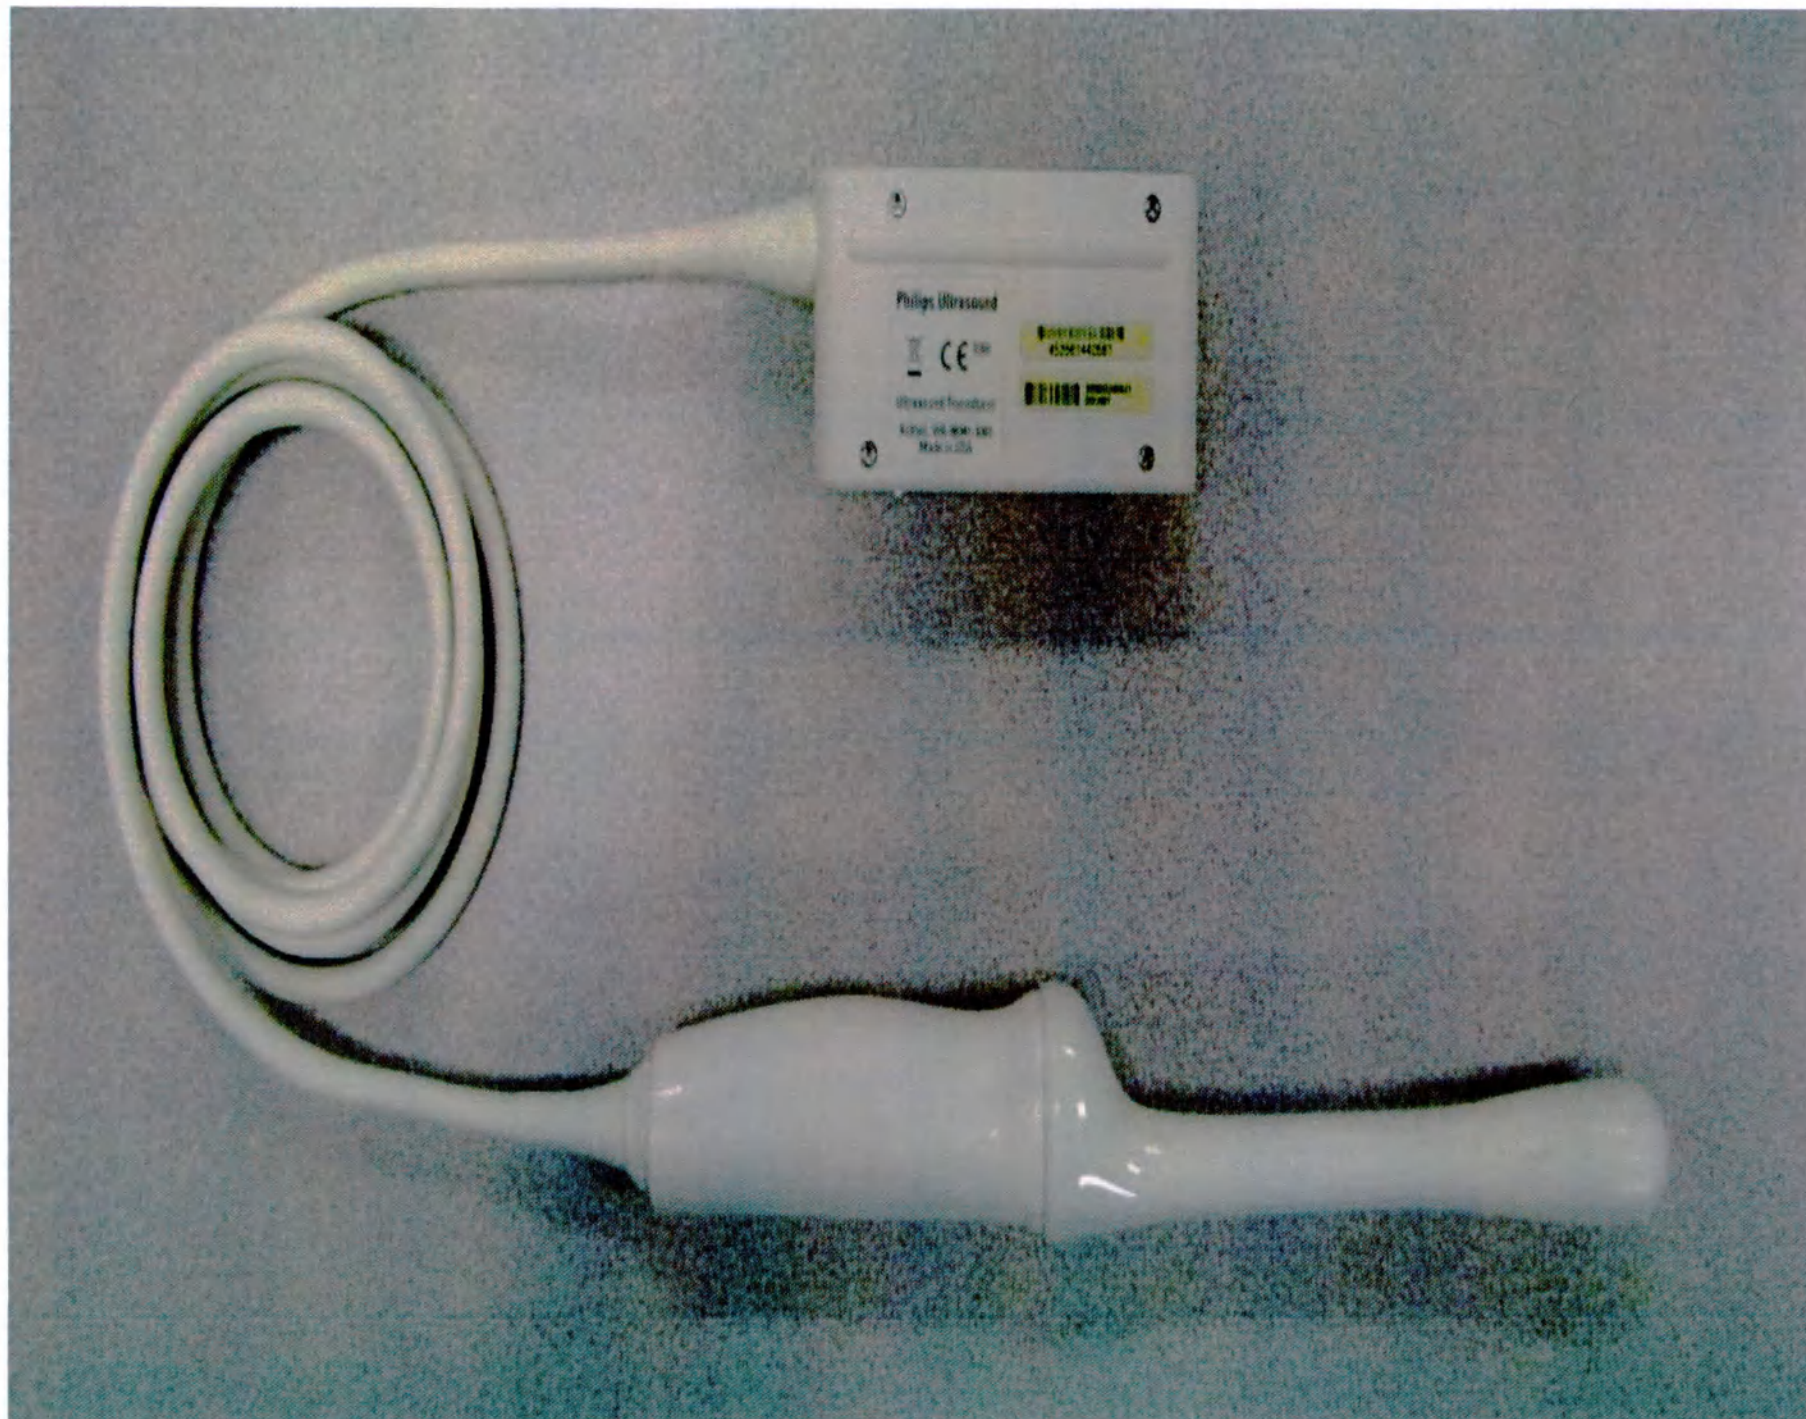

20. Датчик с конвексной матрицей 3D9-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).



21. Датчик карандашный (волновой) D2CWC, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

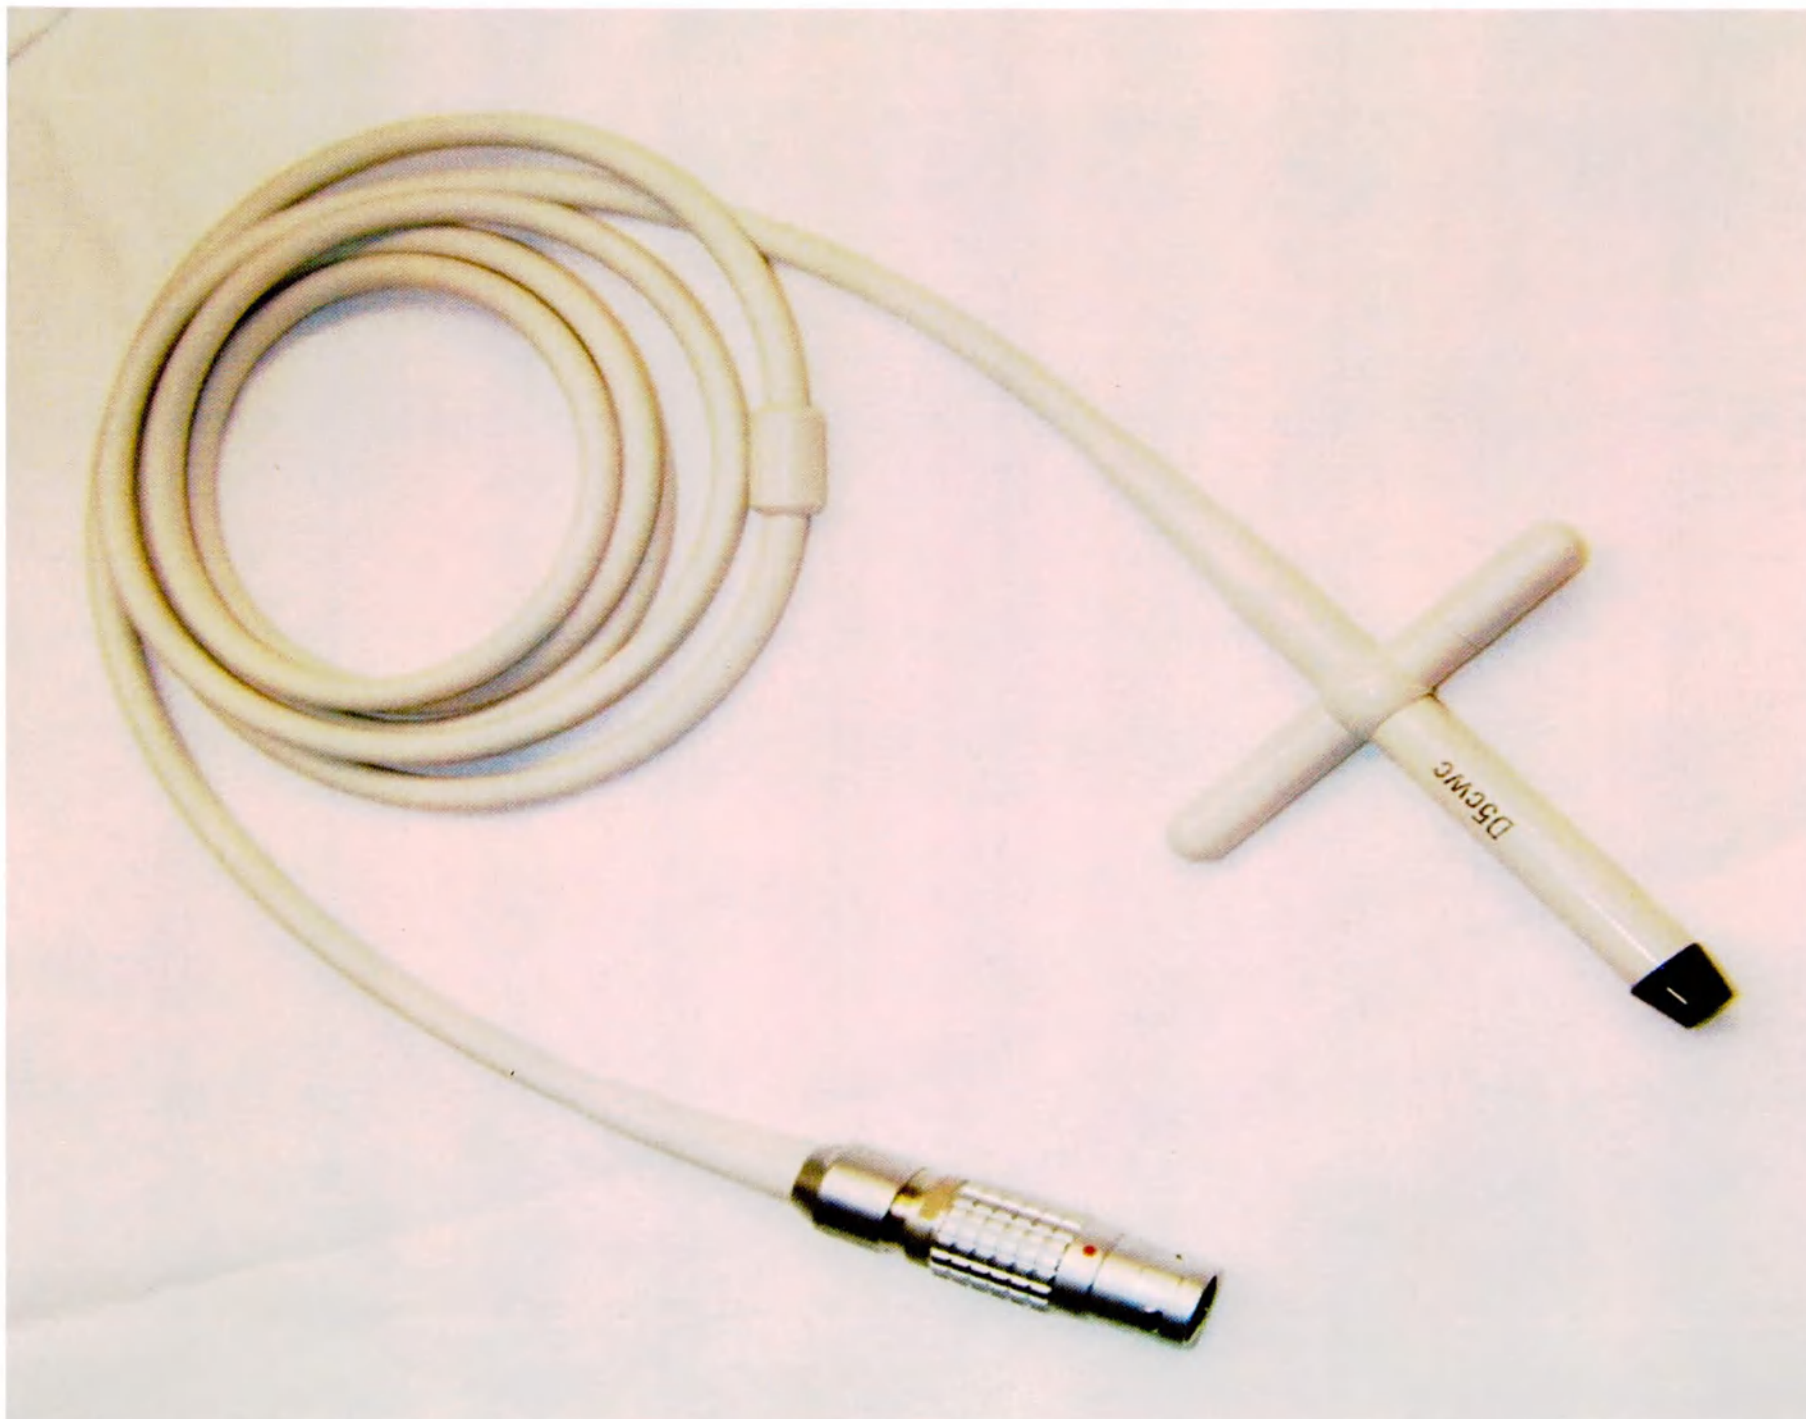


22. Датчик карандашный (волновой) D5cwc, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);



23. Датчик карандашный (волновой) D2tcd, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;




24. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X7-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

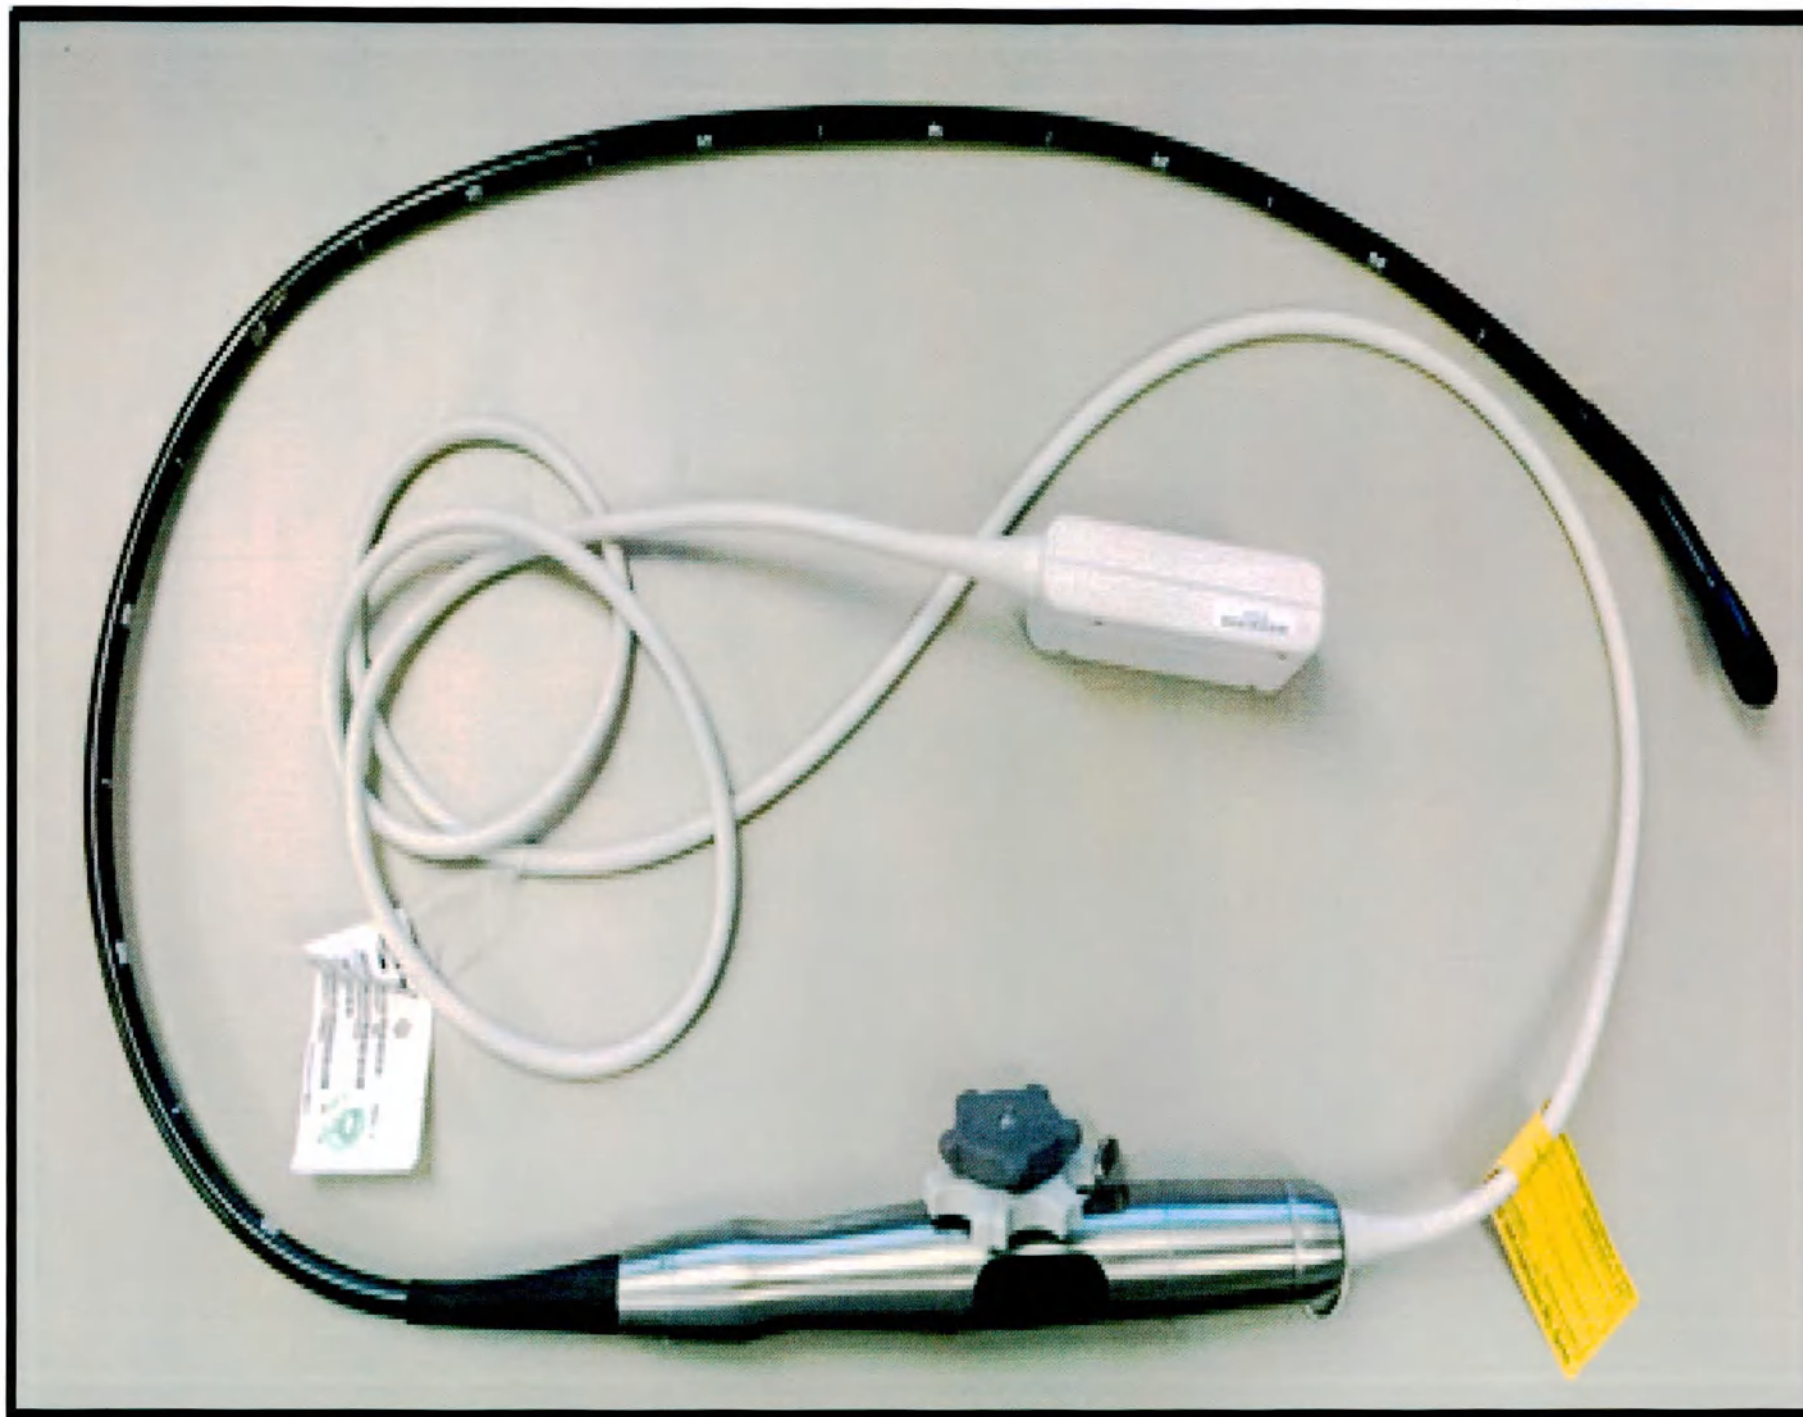

25. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X8-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)..



26. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для взрослых – не более 15 шт. (при необходимости).

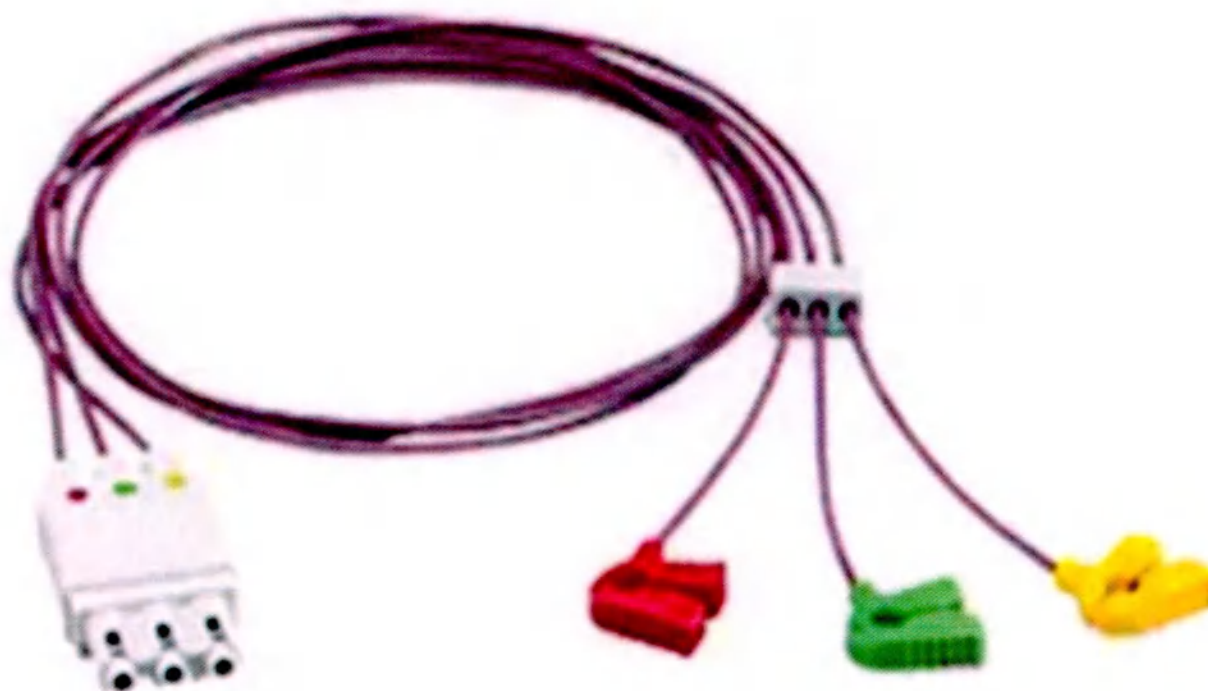

27. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для детей – не более 15 шт. (при необходимости).



28. Кабель вспомогательного входного сигнала – не более 15 шт. (при необходимости).




29. Кабель ЭКГ, длина не более 3 м – не более 15 шт. (при необходимости). – не более 15 шт. (при необходимости).



30. Шнур питания европейский 4,28 м – не более 5 шт.



31. Адаптер переменного тока – не более 5 шт. (при необходимости).

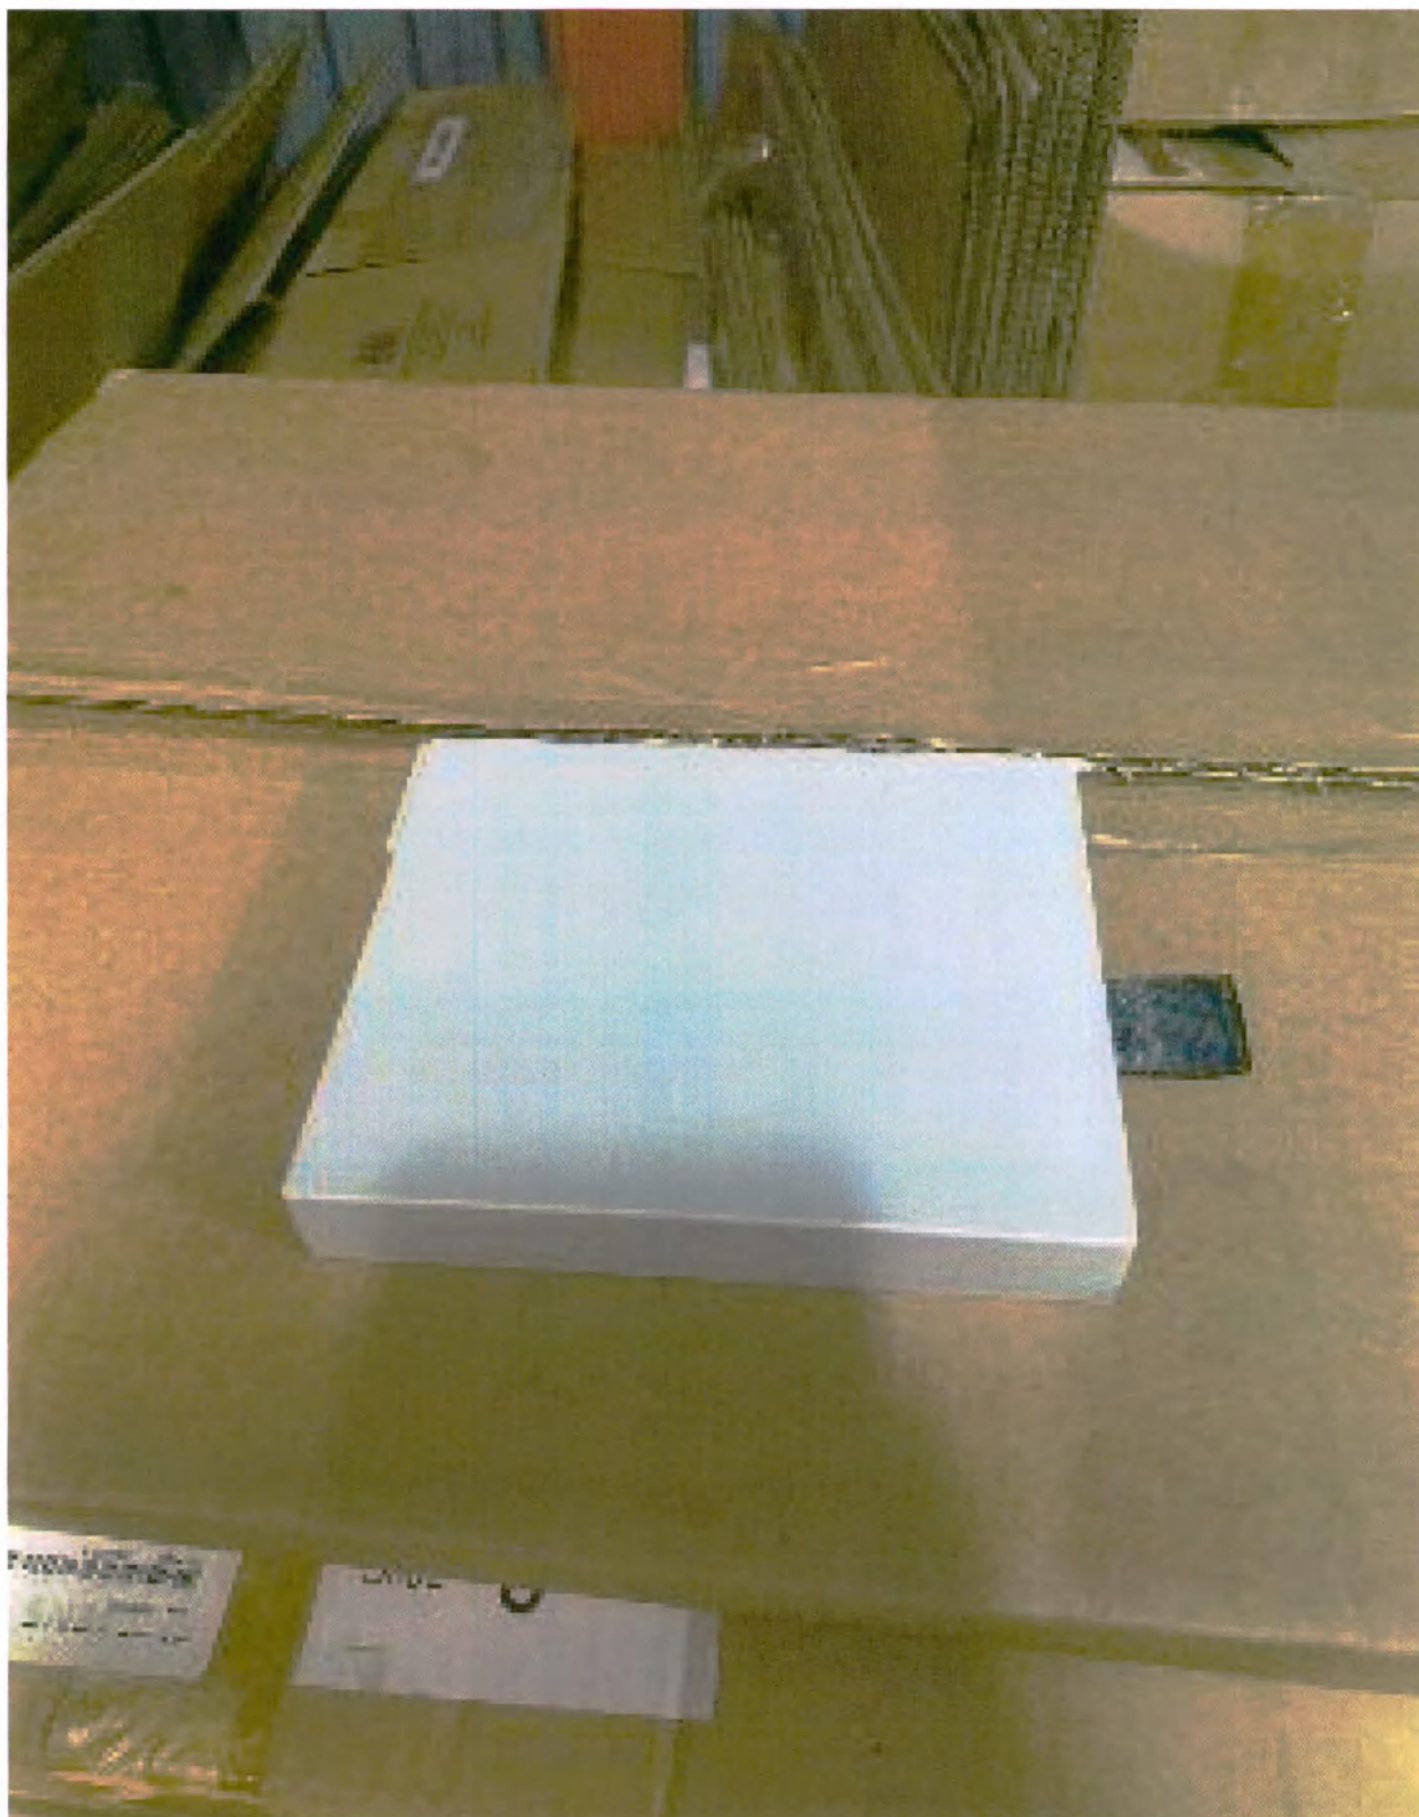

32. Литий- ионный аккумулятор – не более 5 шт. (при необходимости).



33. Ванночка для дезинфекции чреспищеводных датчиков – не более 5 шт. (при необходимости).



Руководство
пользователя

Русский

Ультразвуковые системы серии 5000 Compact

PHILIPS

34. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 34.1 Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



Производство
использования
(интегрированное)

Решения

Package 1.1

Программное обеспечение углубленного количественного анализа QLAB

PHILIPS

34. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 34.1

Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



34. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 34.1 Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 34.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;






35. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе

Принадлежности:



1. Переключатель ножной – 1 шт..

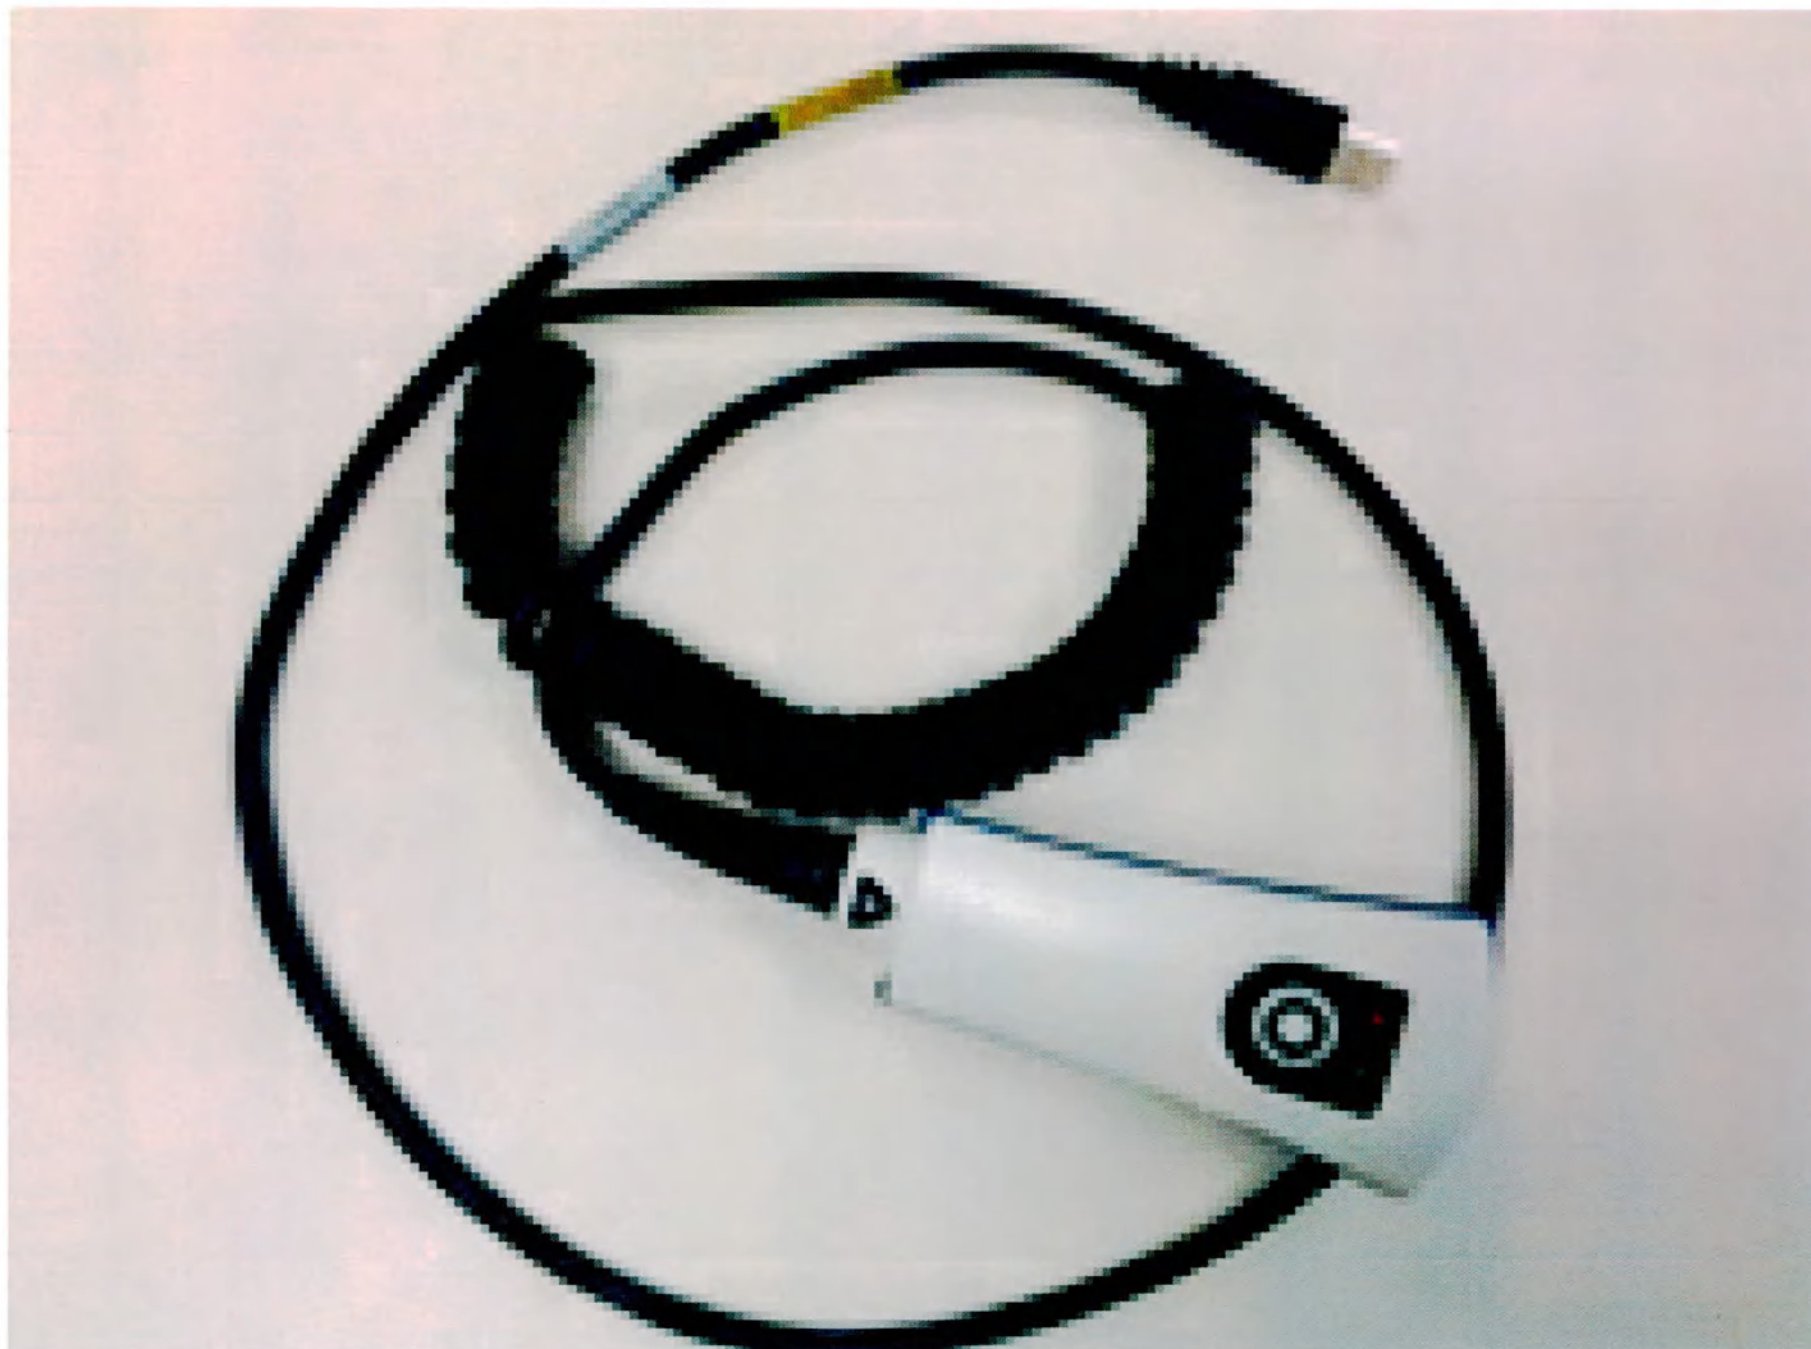

2. Сканнер штрихкода – 1 шт.



3. Кабель вывода видеосигнала – не более 5 шт.




4. Кабель ЛС сетевой – не более 5 шт.




5. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D898MD, производства компании Sony – не более 5 шт



6. Органайзер для кабелей датчиков – 2 шт.

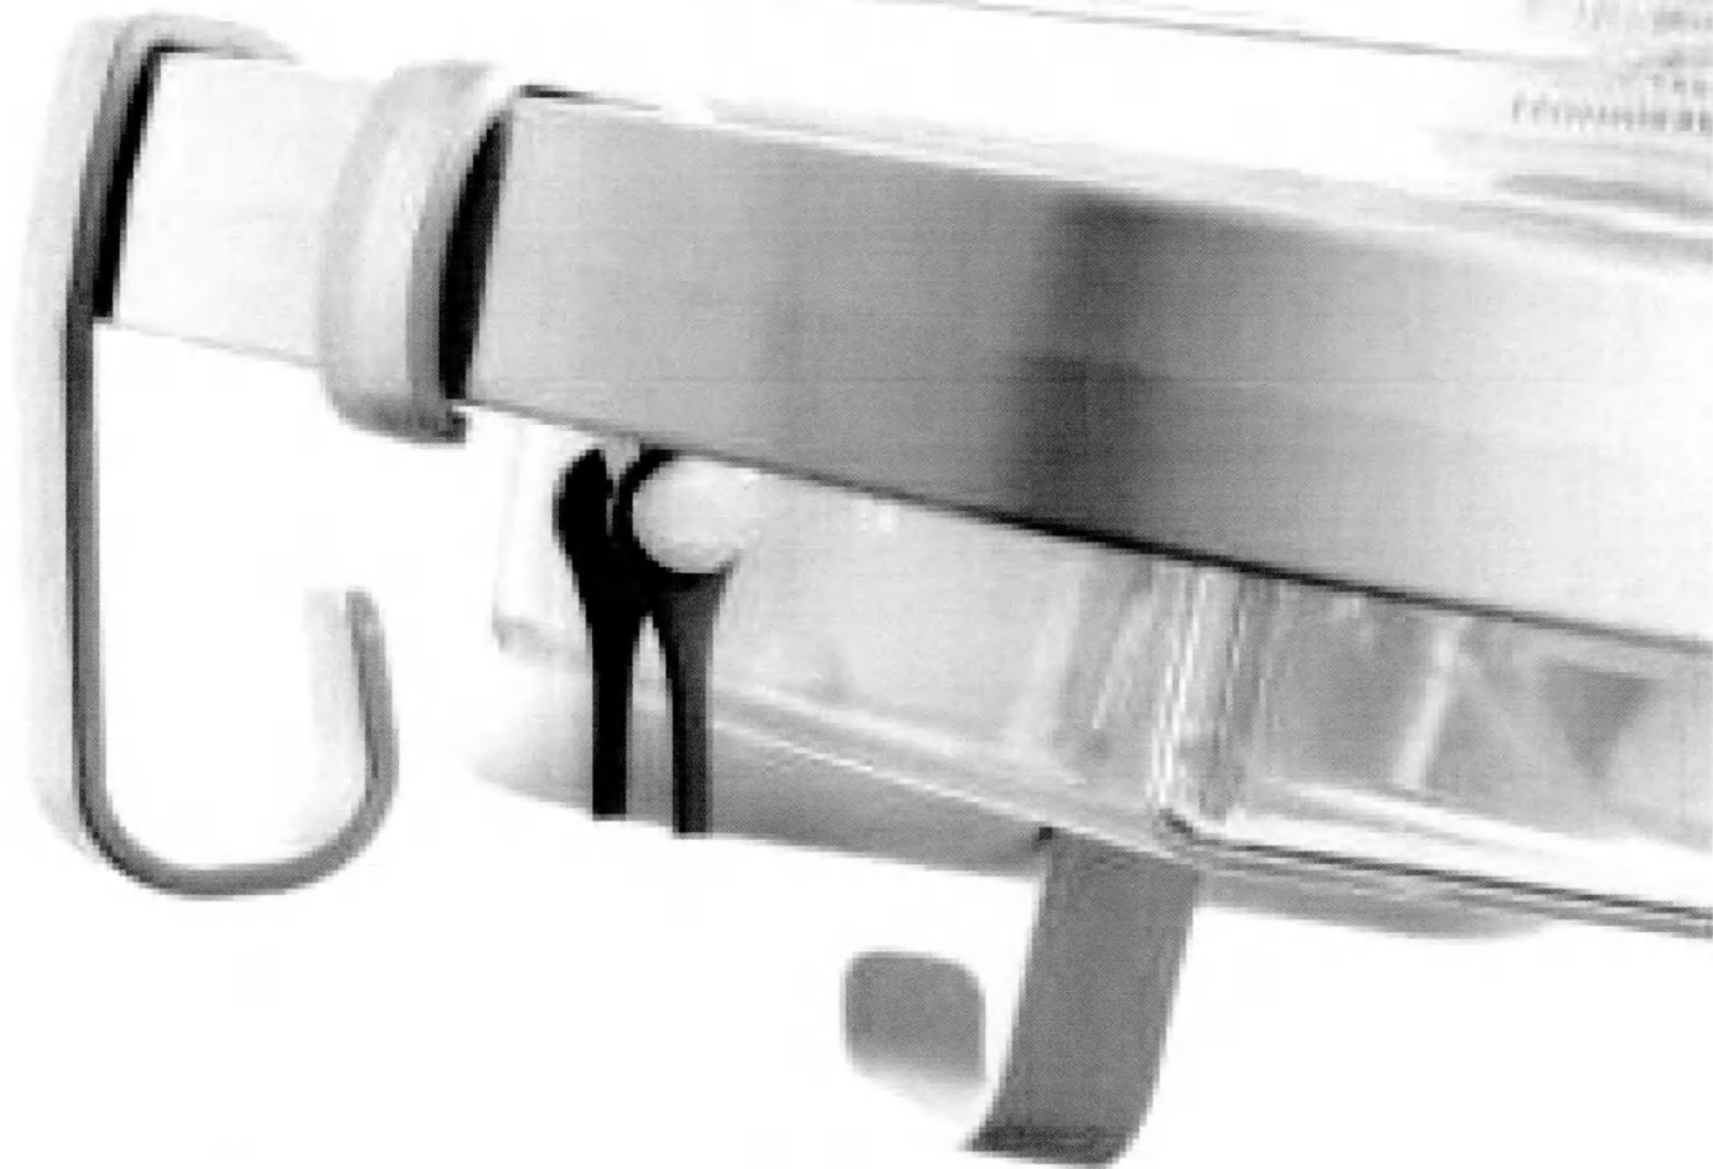

7. Захваты кабелей – 2 шт.

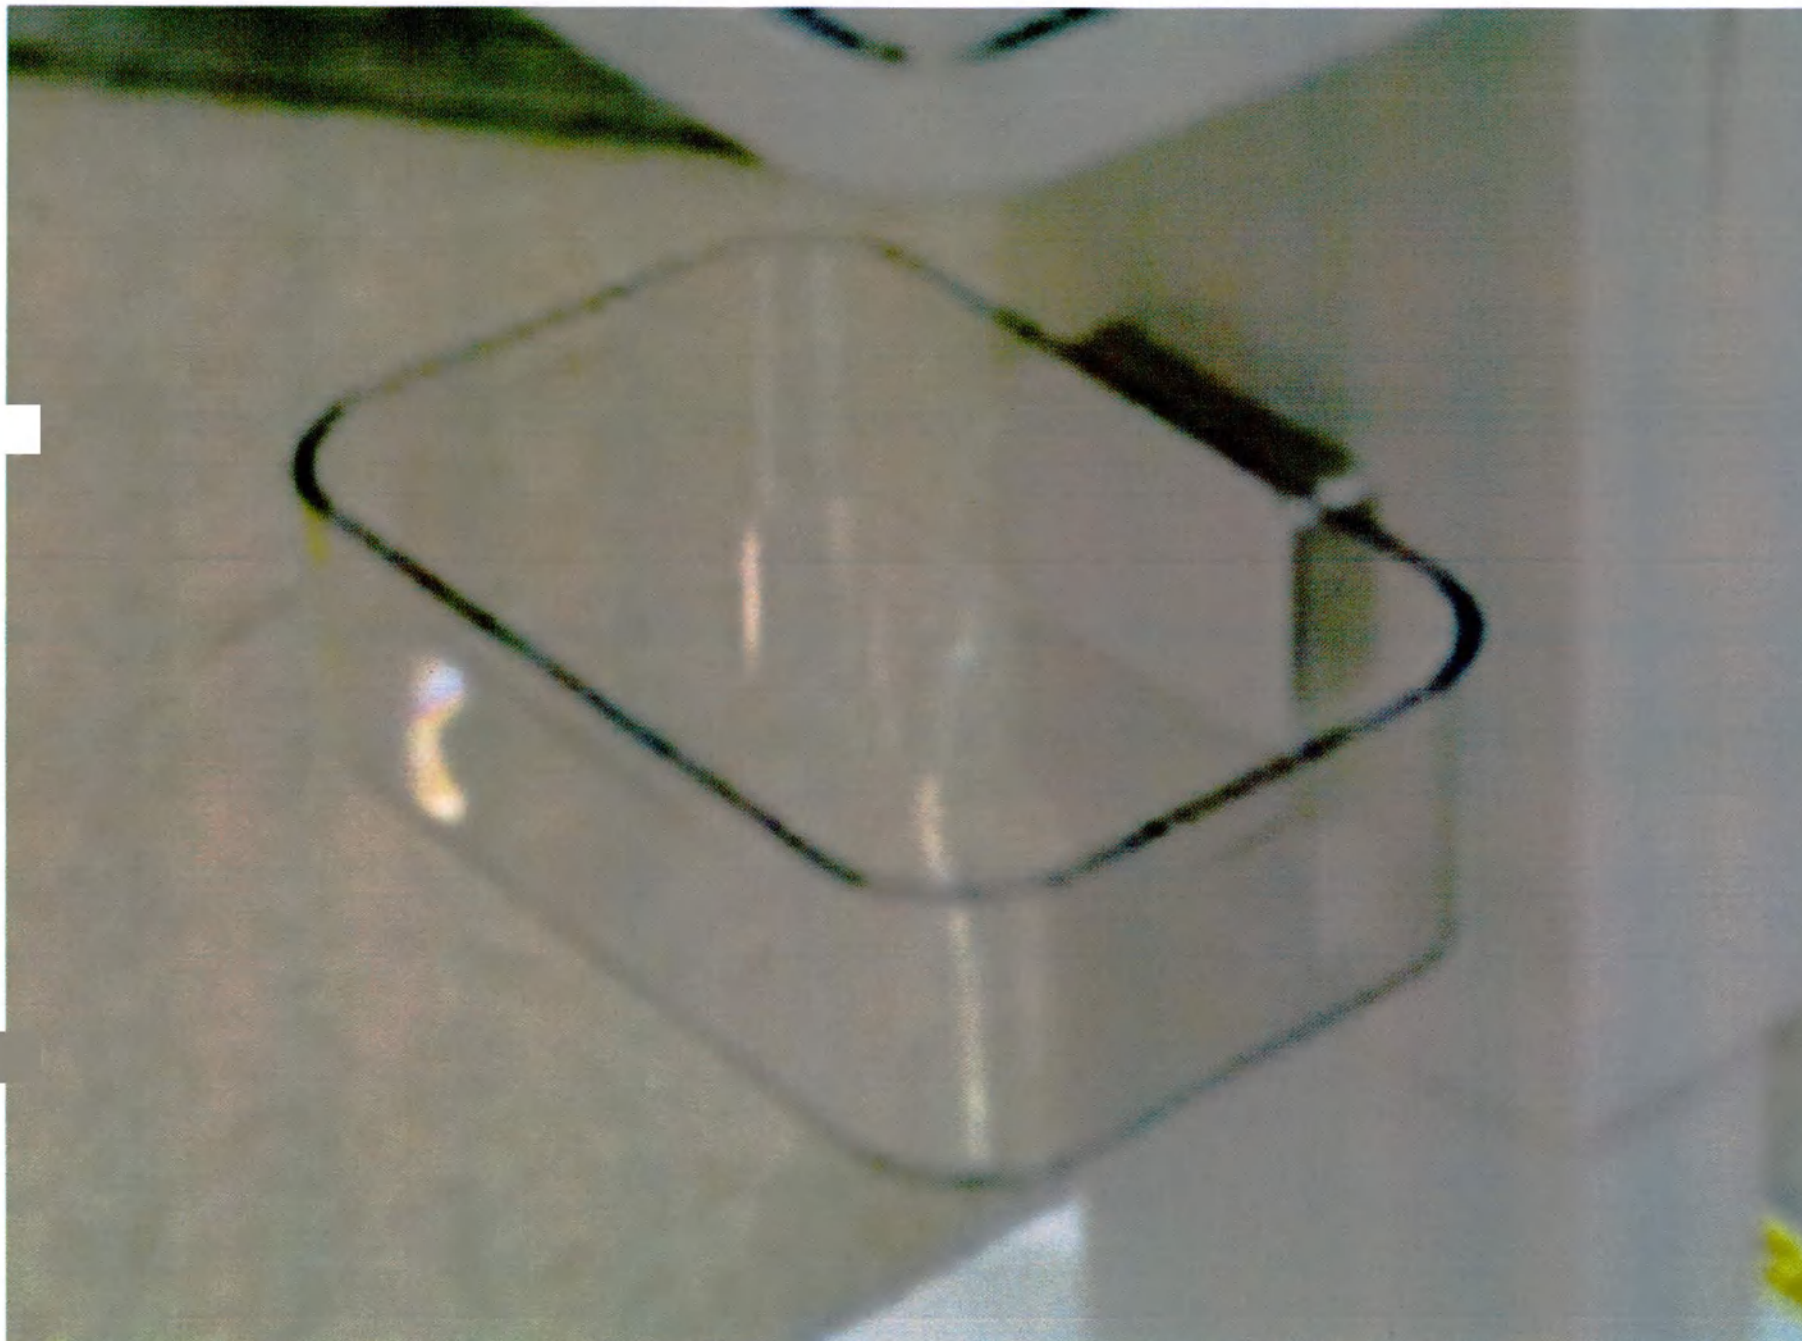

8. Отсек для хранения – 1 шт.


III. Система ультразвуковая серии 5000 Contrast с принадлежностями вариант исполнения 5500 CV, в составе:




1. Блок основной ультразвуковой системы вариант исполнения 5500 CV – 1 шт.;




2. Тележка, варианты исполнения: Тележка Standard; Тележка Extended; Тележка Deluxe; Тележка Premium с полкой для принтера

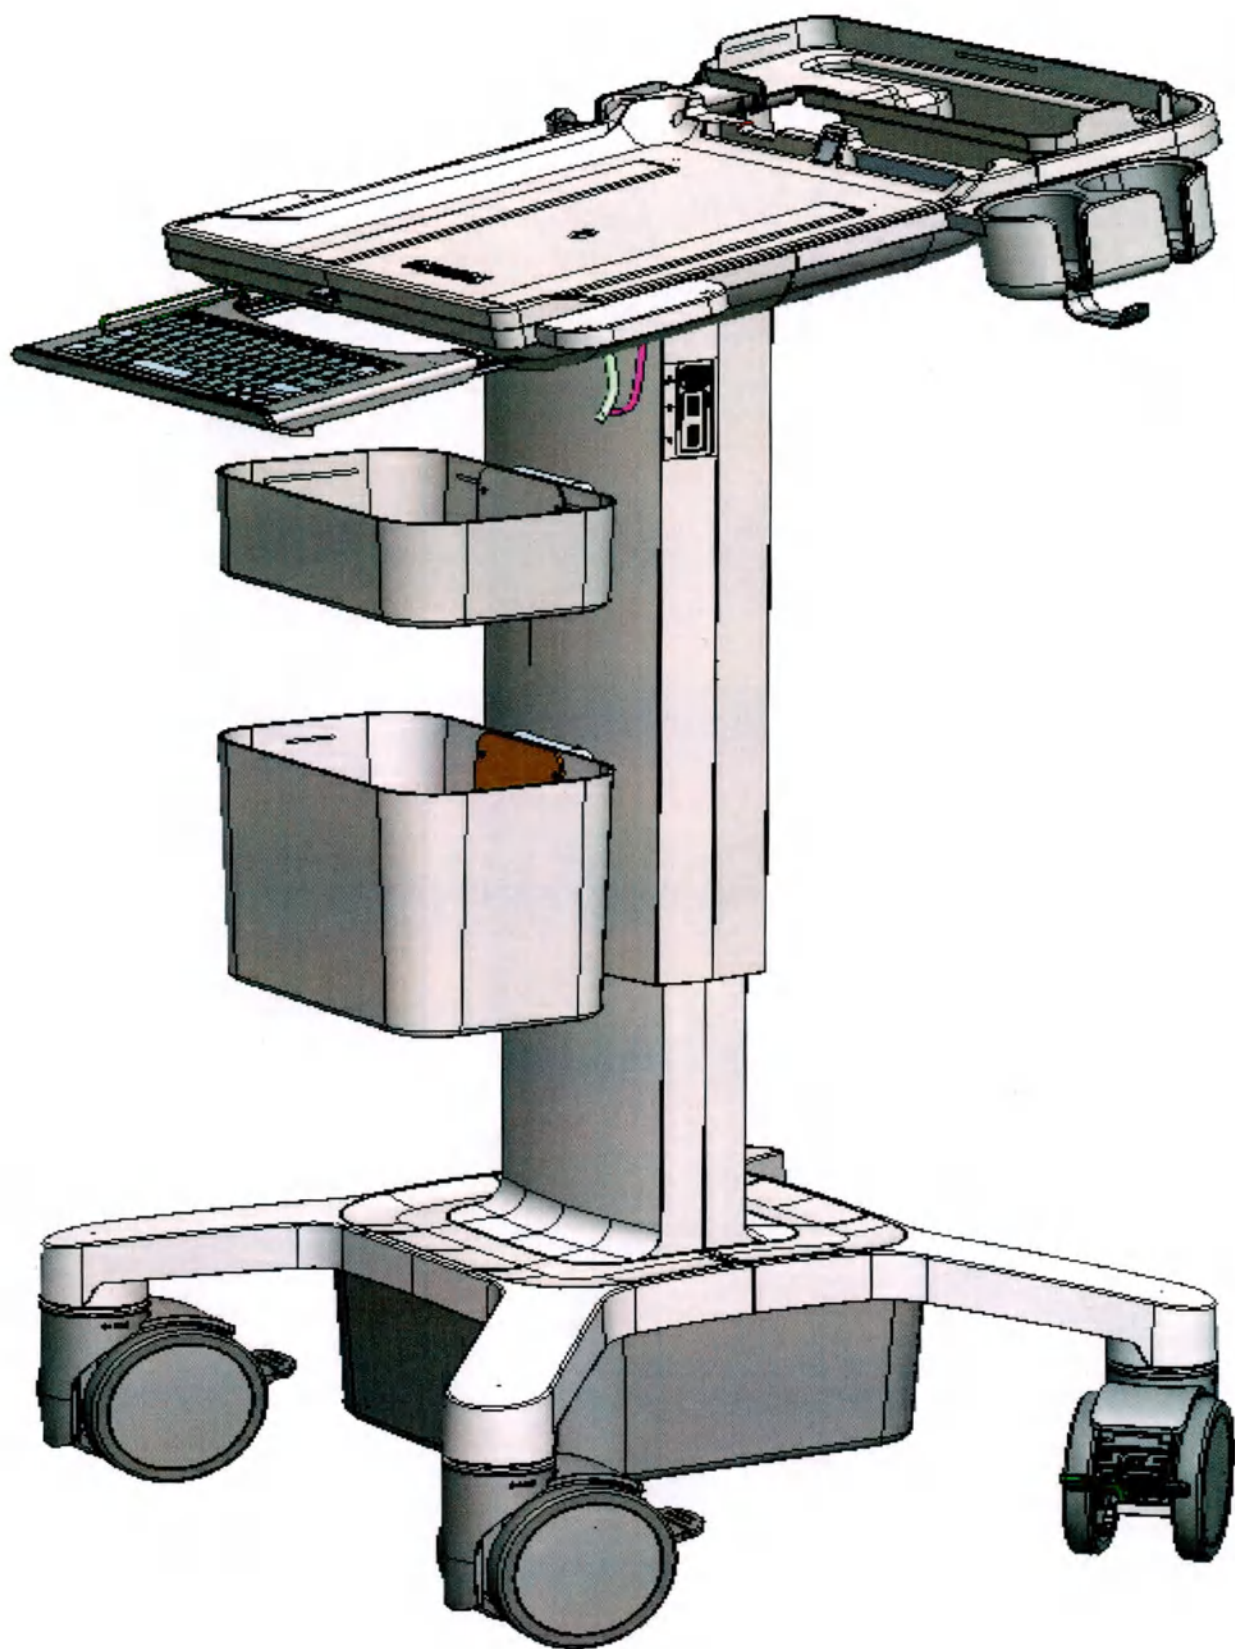


2.1. Тележка Standard – 1 шт. (при необходимости);

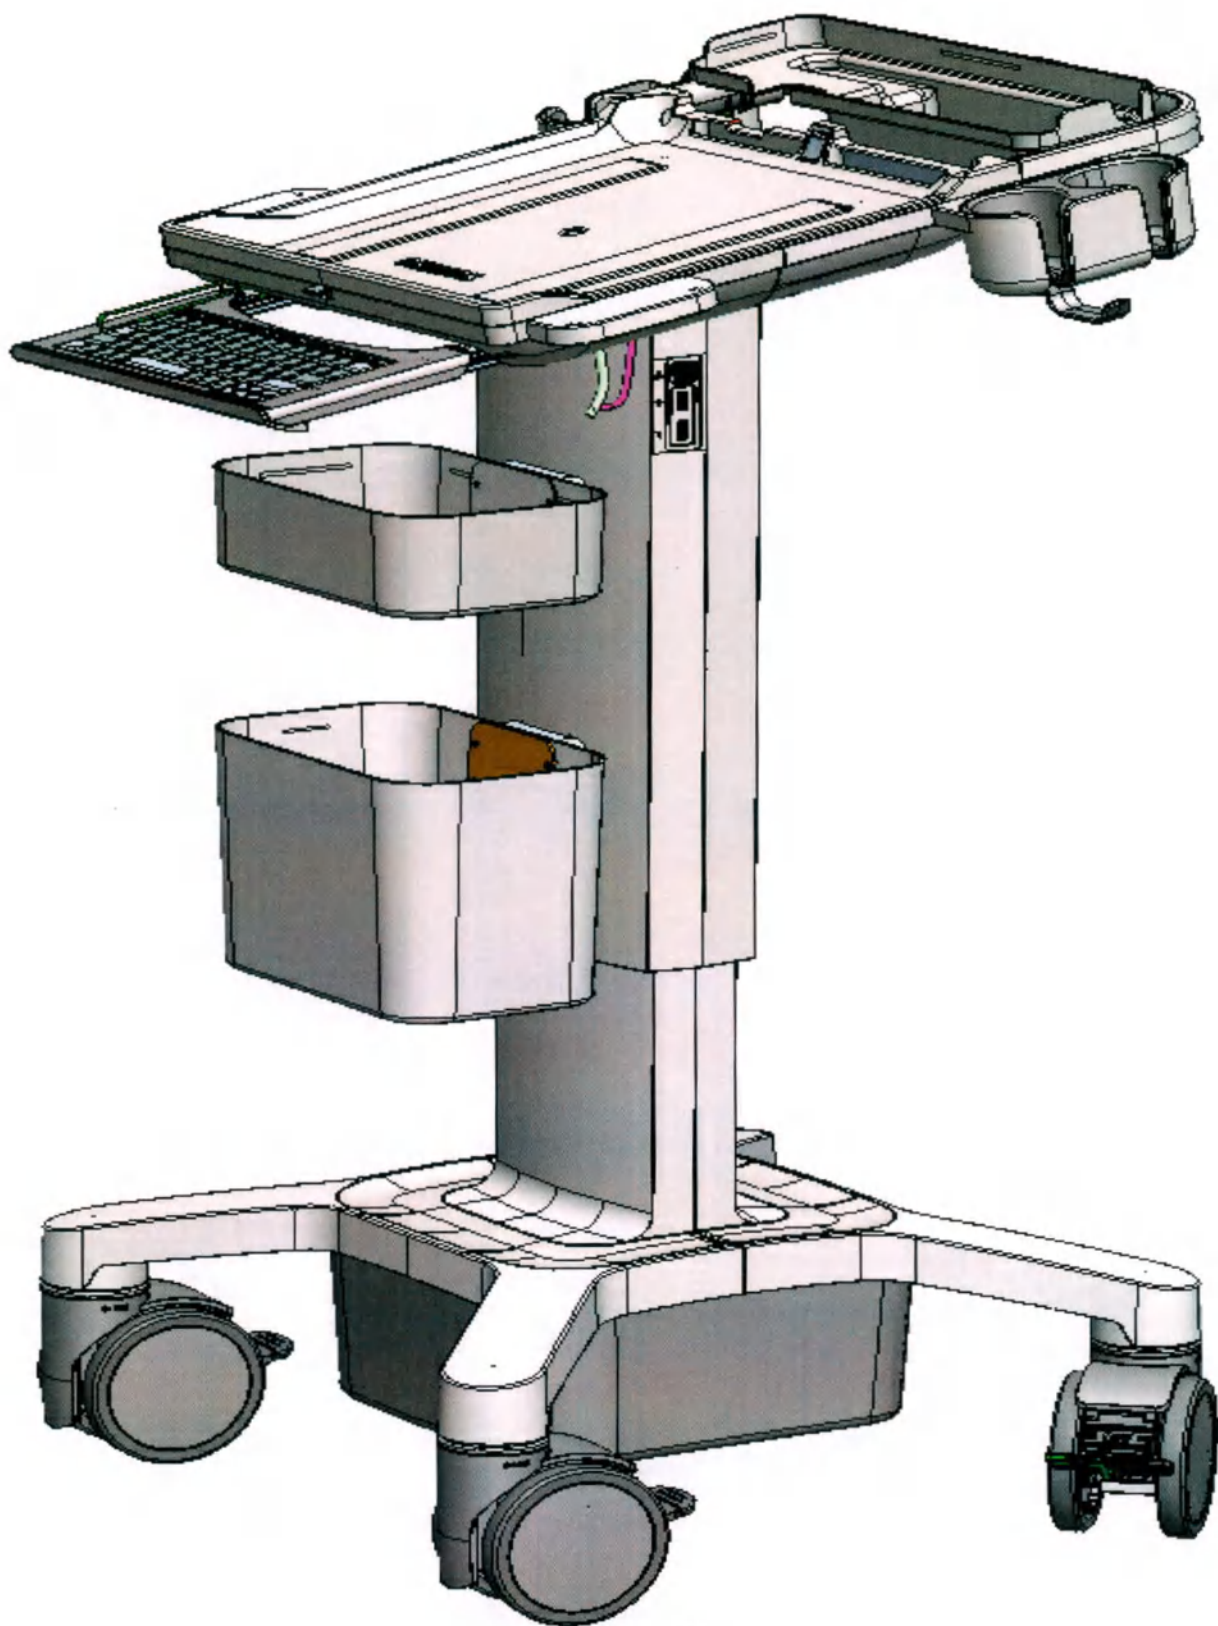


2.2. Тележка Extended – 1 шт. (при необходимости);

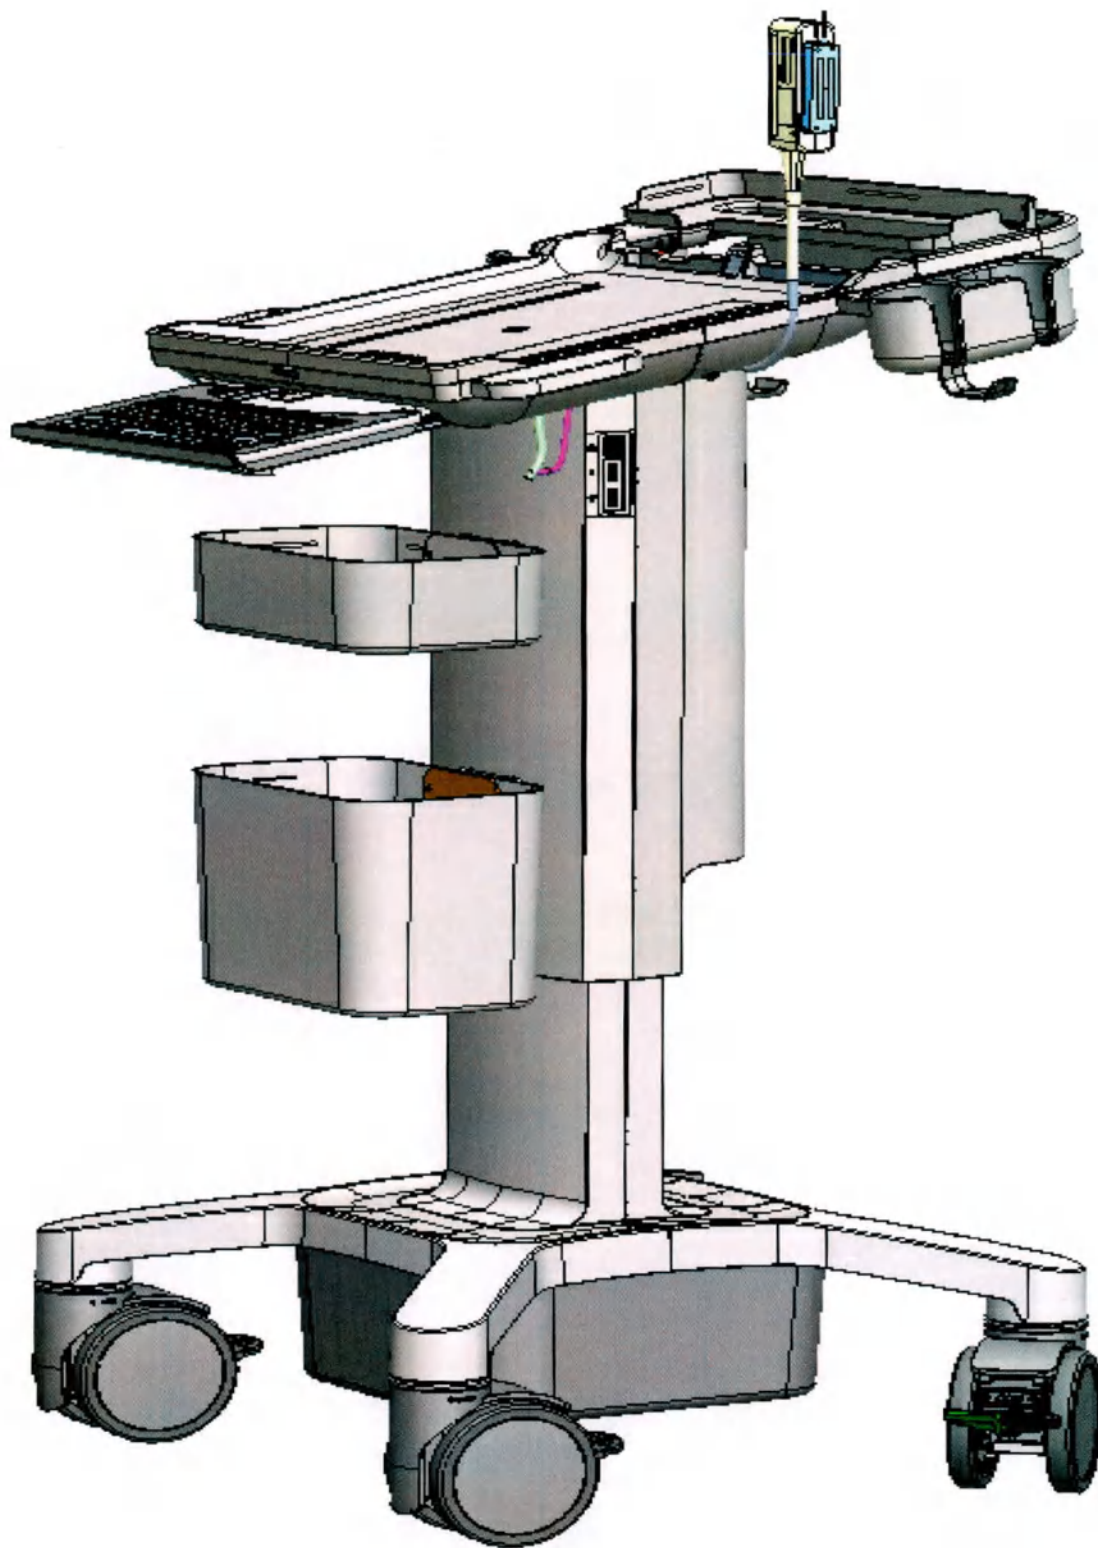

2.3. Тележка Deluxe – 1 шт. (при необходимости);

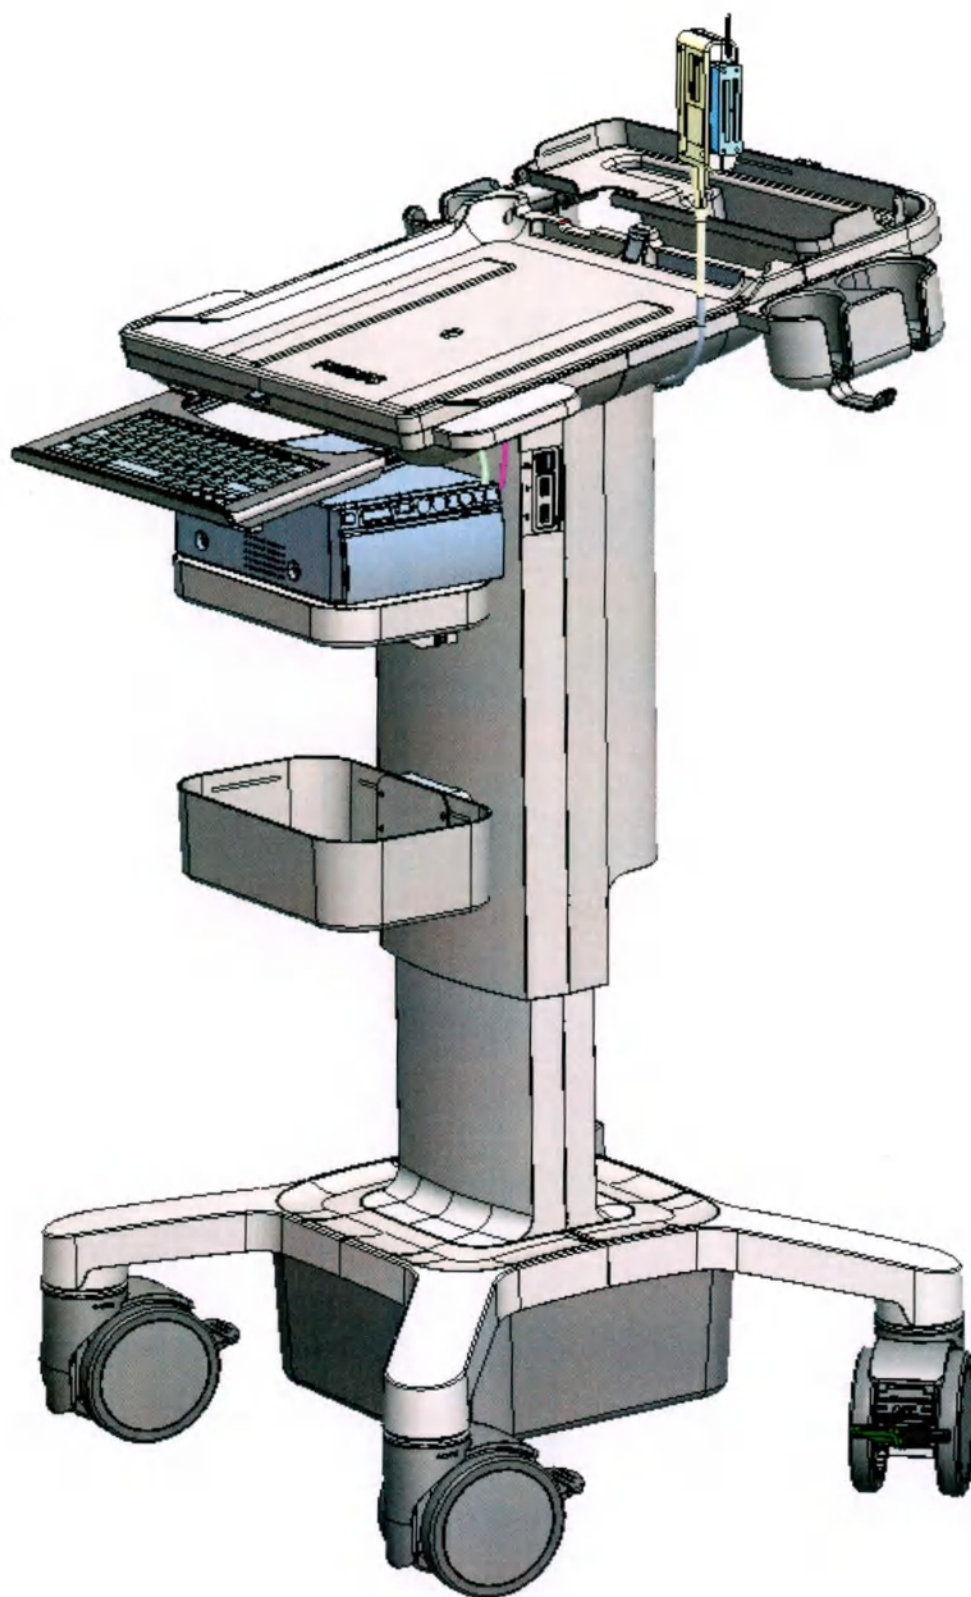

2.4. Тележка Premium с полкой для принтера

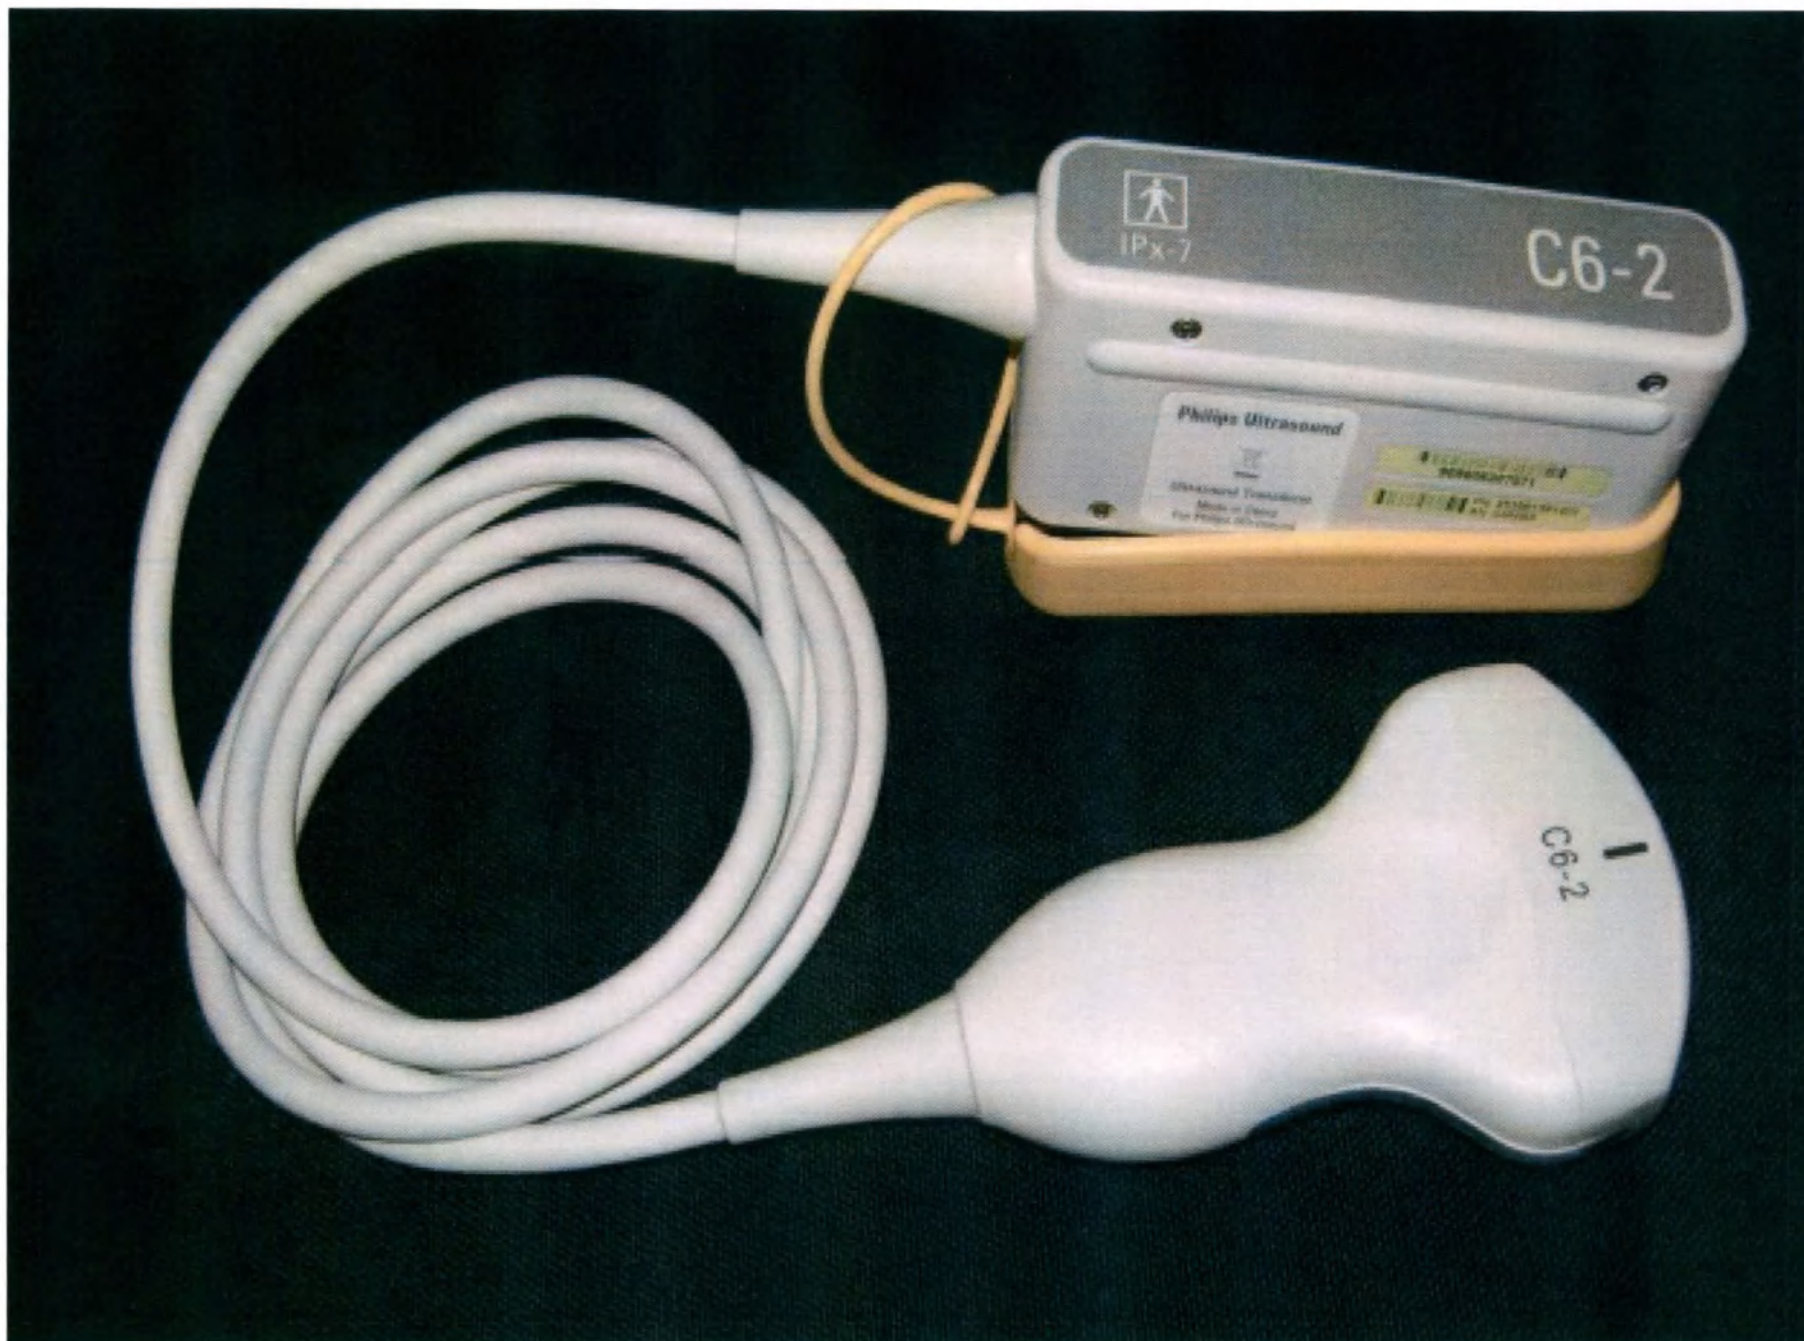

3. Датчик с конвексной матрицей С6-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




4. Датчик с конвексной матрицей С8-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);




5. Датчик с конвексной матрицей C5-1, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).



6. Датчик с конвексной матрицей C9-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

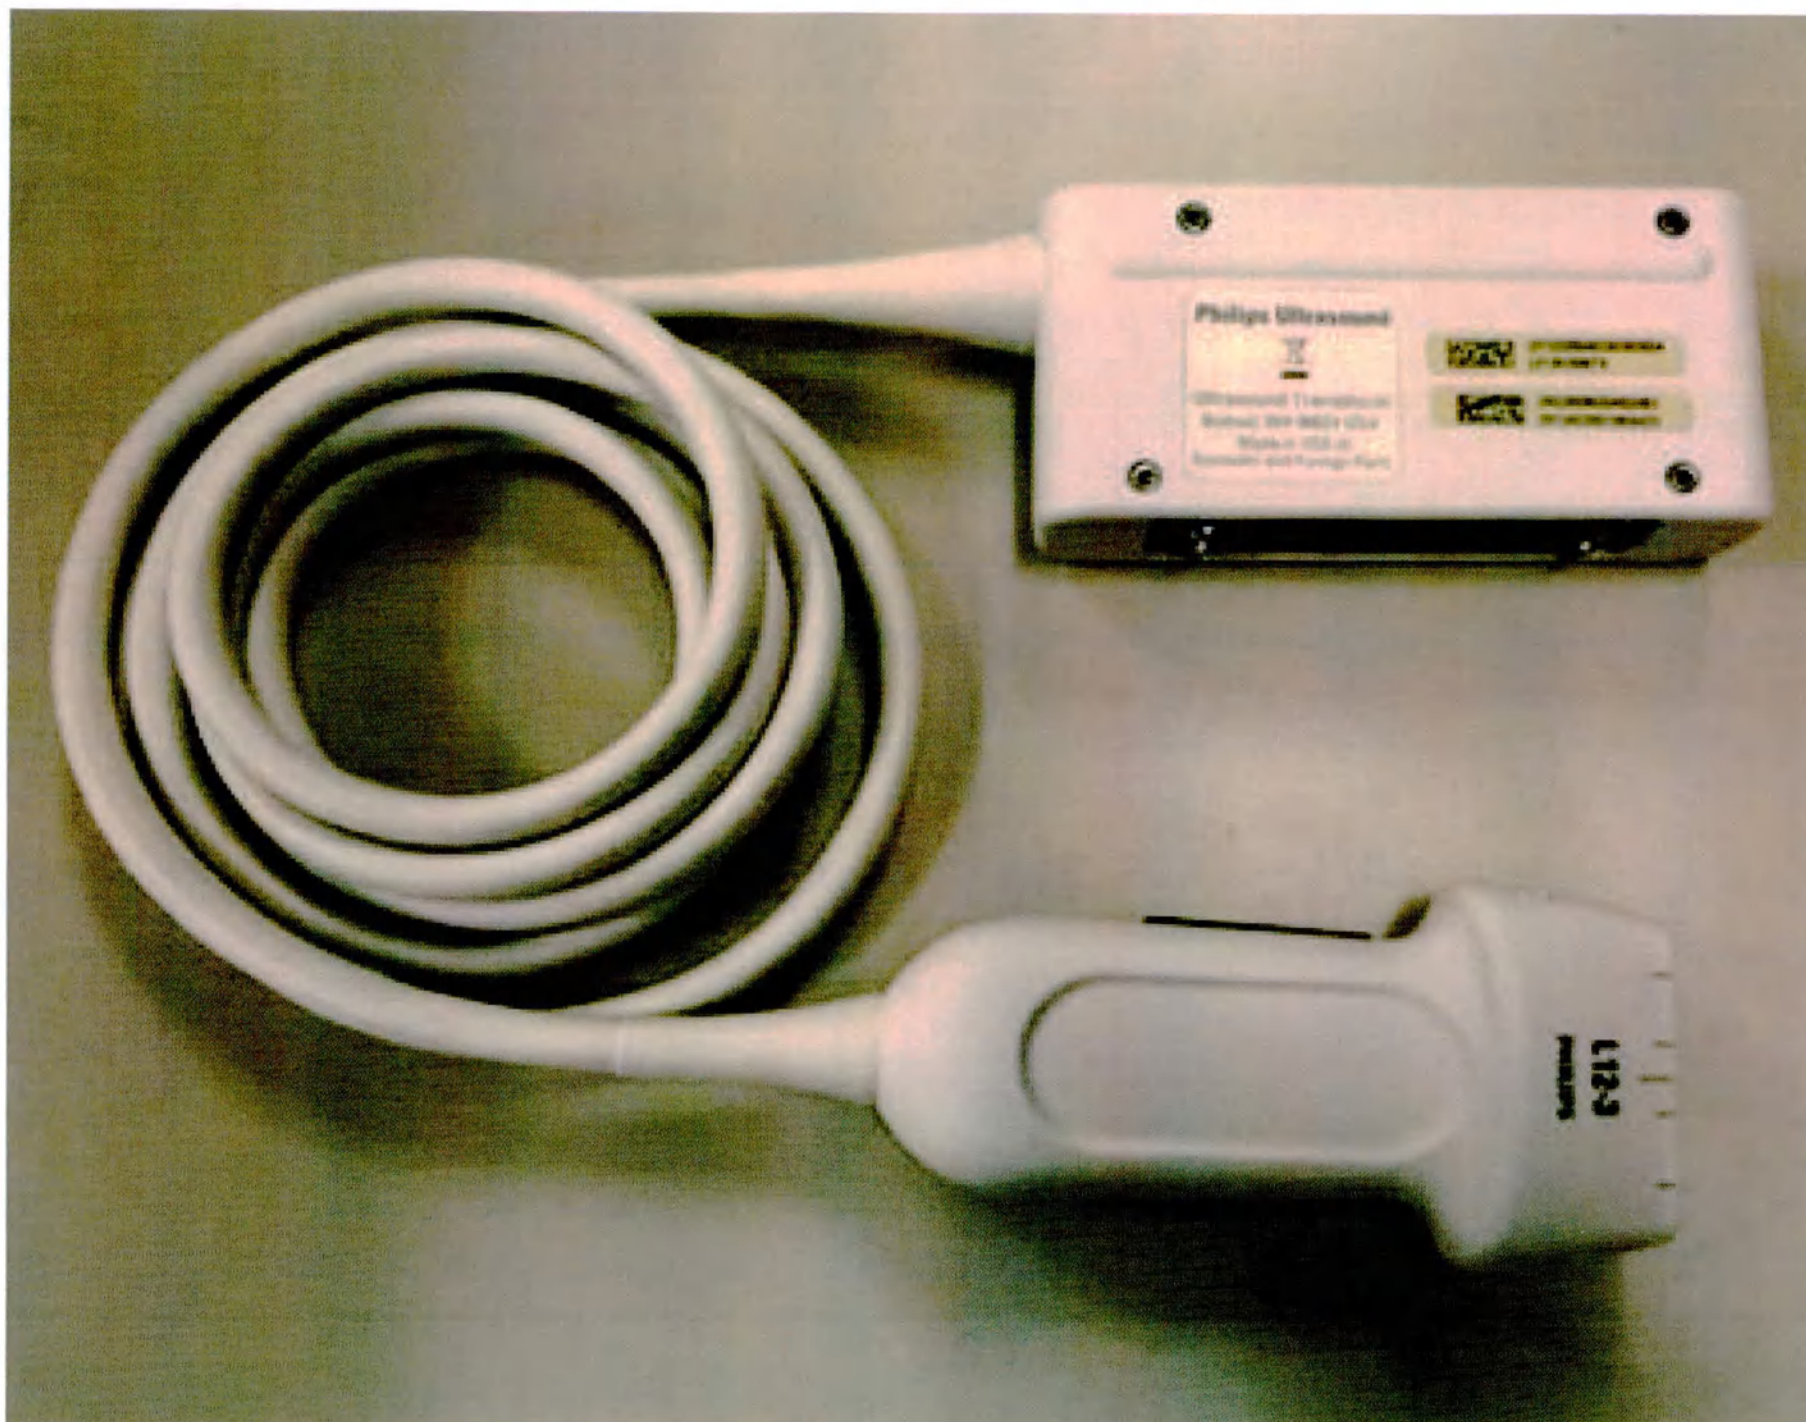

7. Датчик с линейной матрицей L12-3 ERGO, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

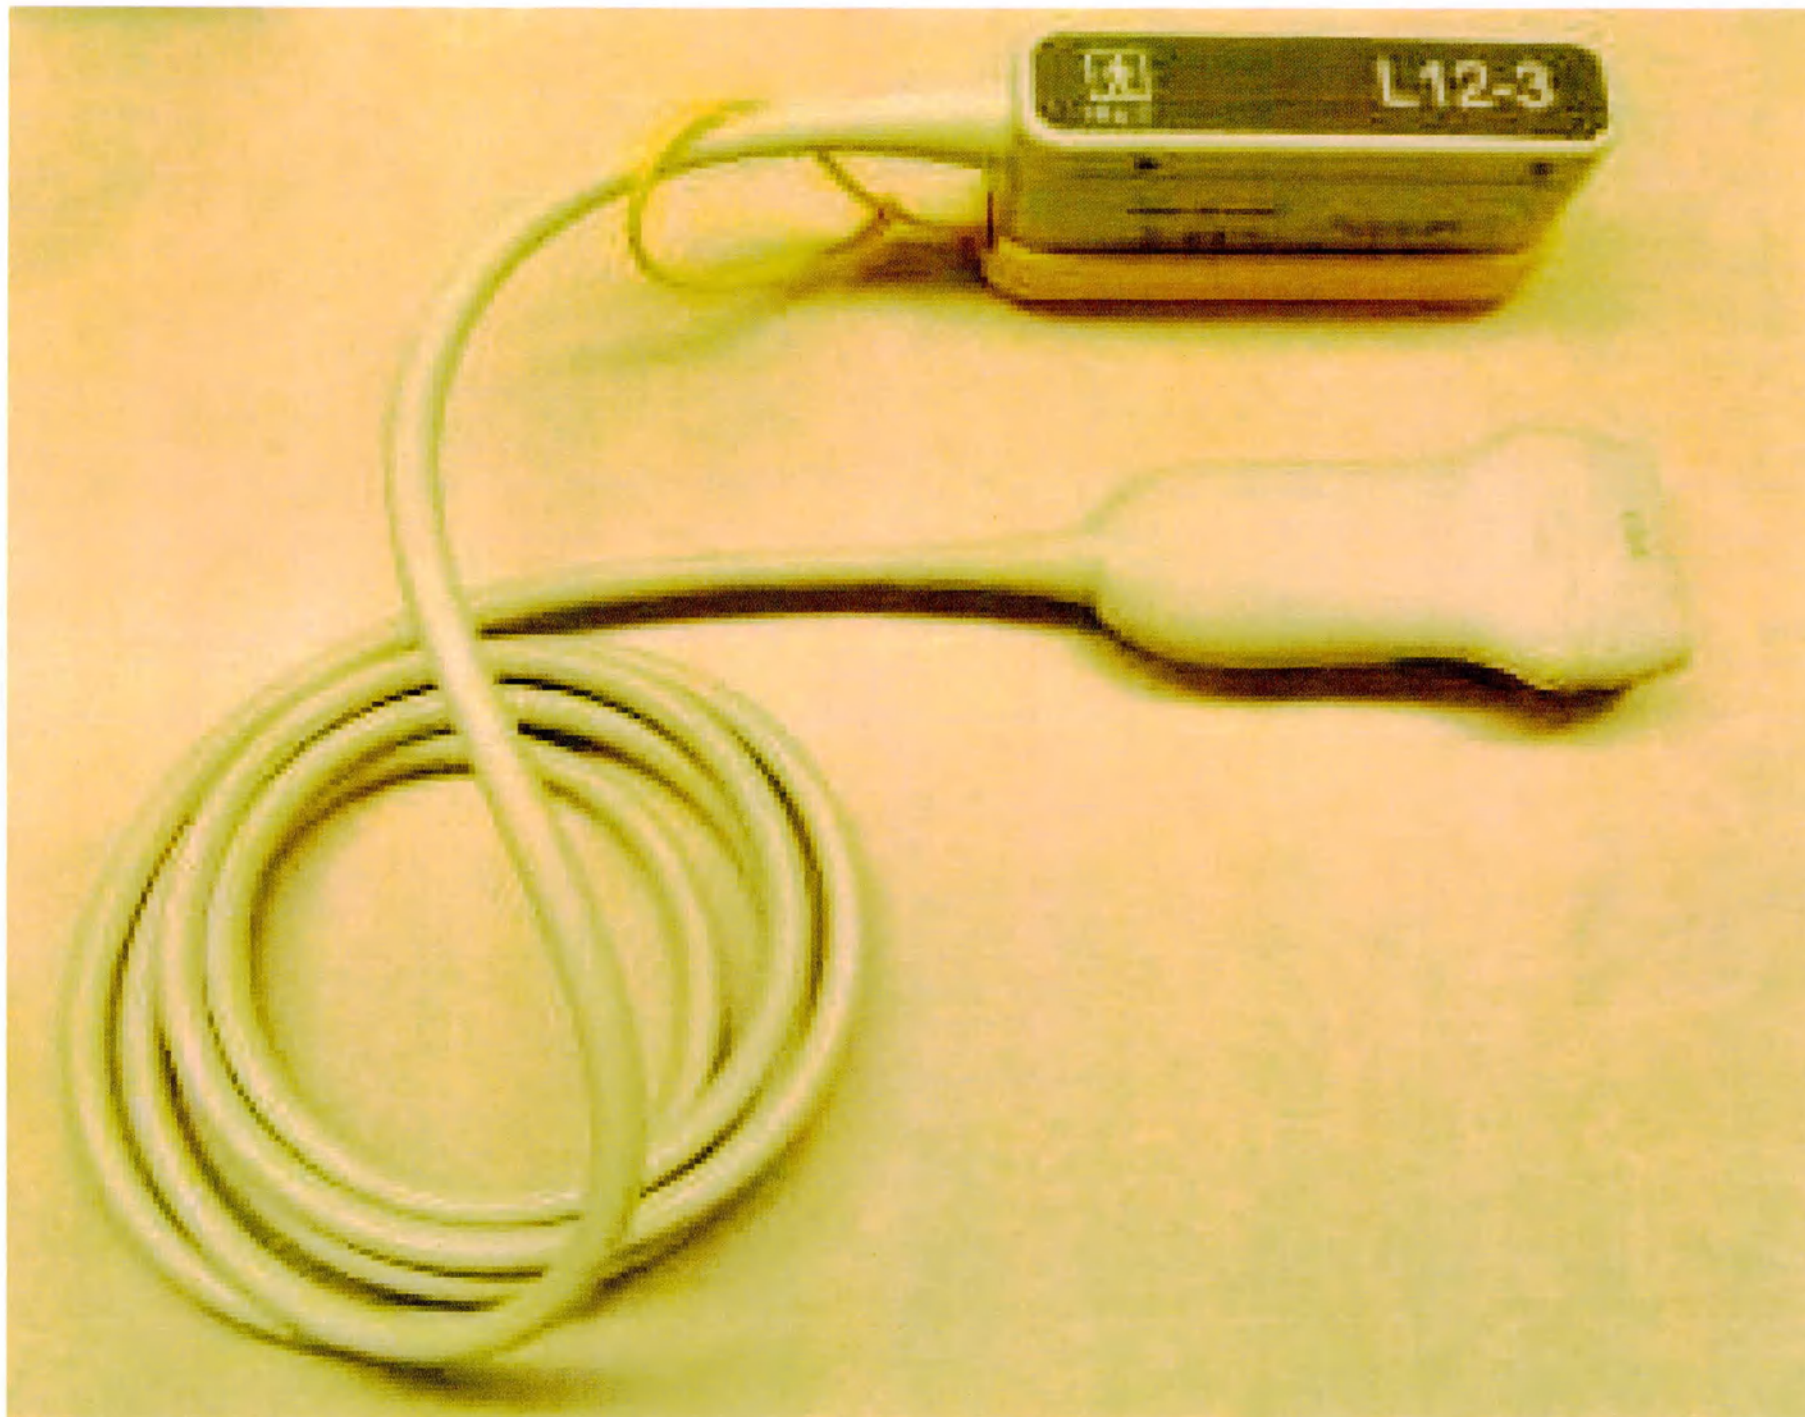

8. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;



8. Датчик с линейной матрицей L12-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;



9. Датчик с линейной матрицей L12-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;




10. Датчик с линейной матрицей L15-7ю, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;



11. Датчик с линейной матрицей L18-5, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;




12. Датчик с линейной матрицей eL18-4, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).

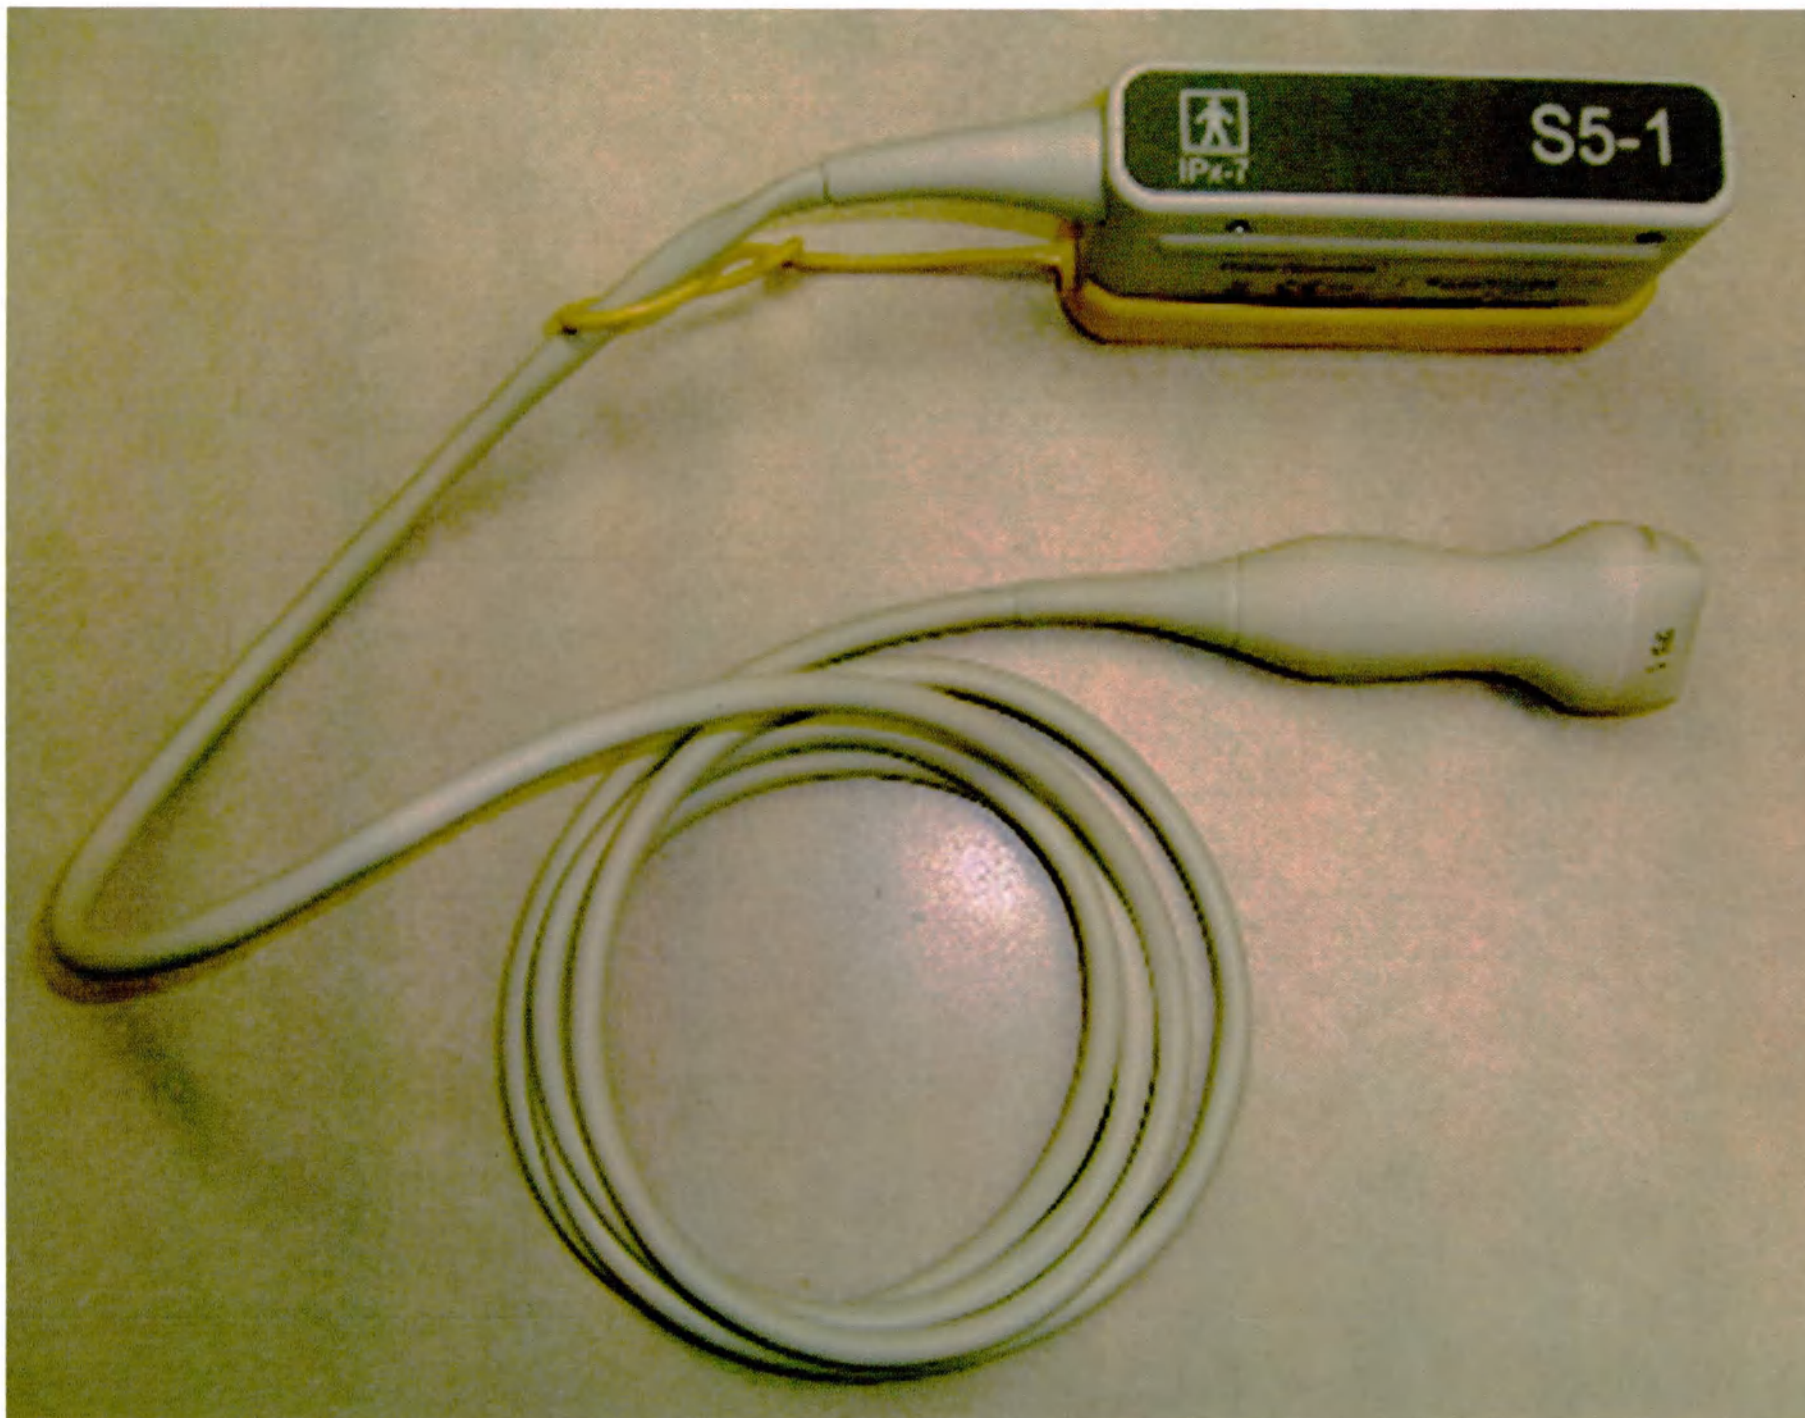

13. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S5-1, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).



14. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)

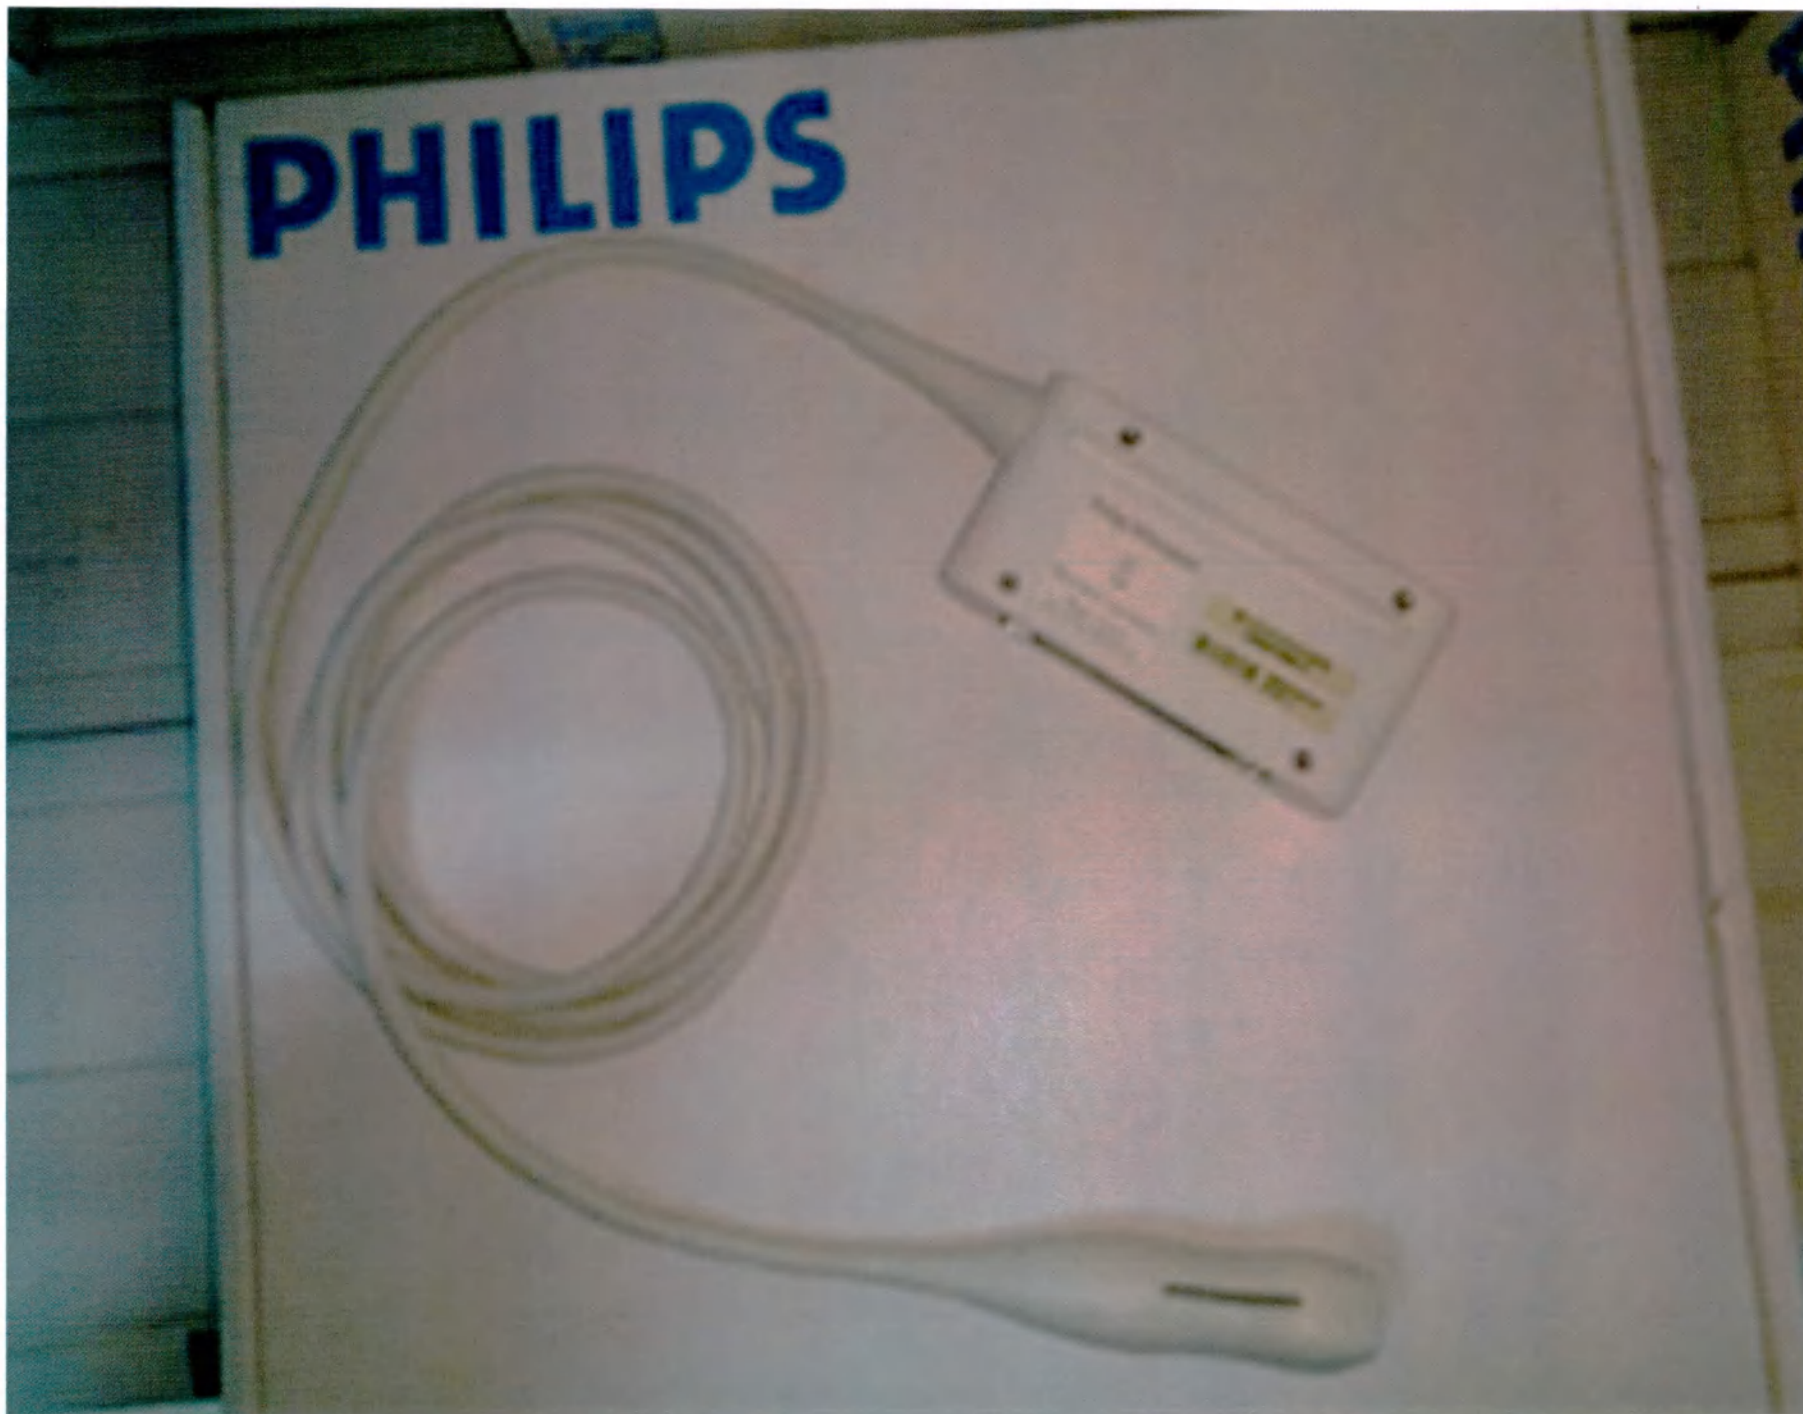


14. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S8-3, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)



15. Датчик с фазированной (векторной) матрицей S4-2, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)




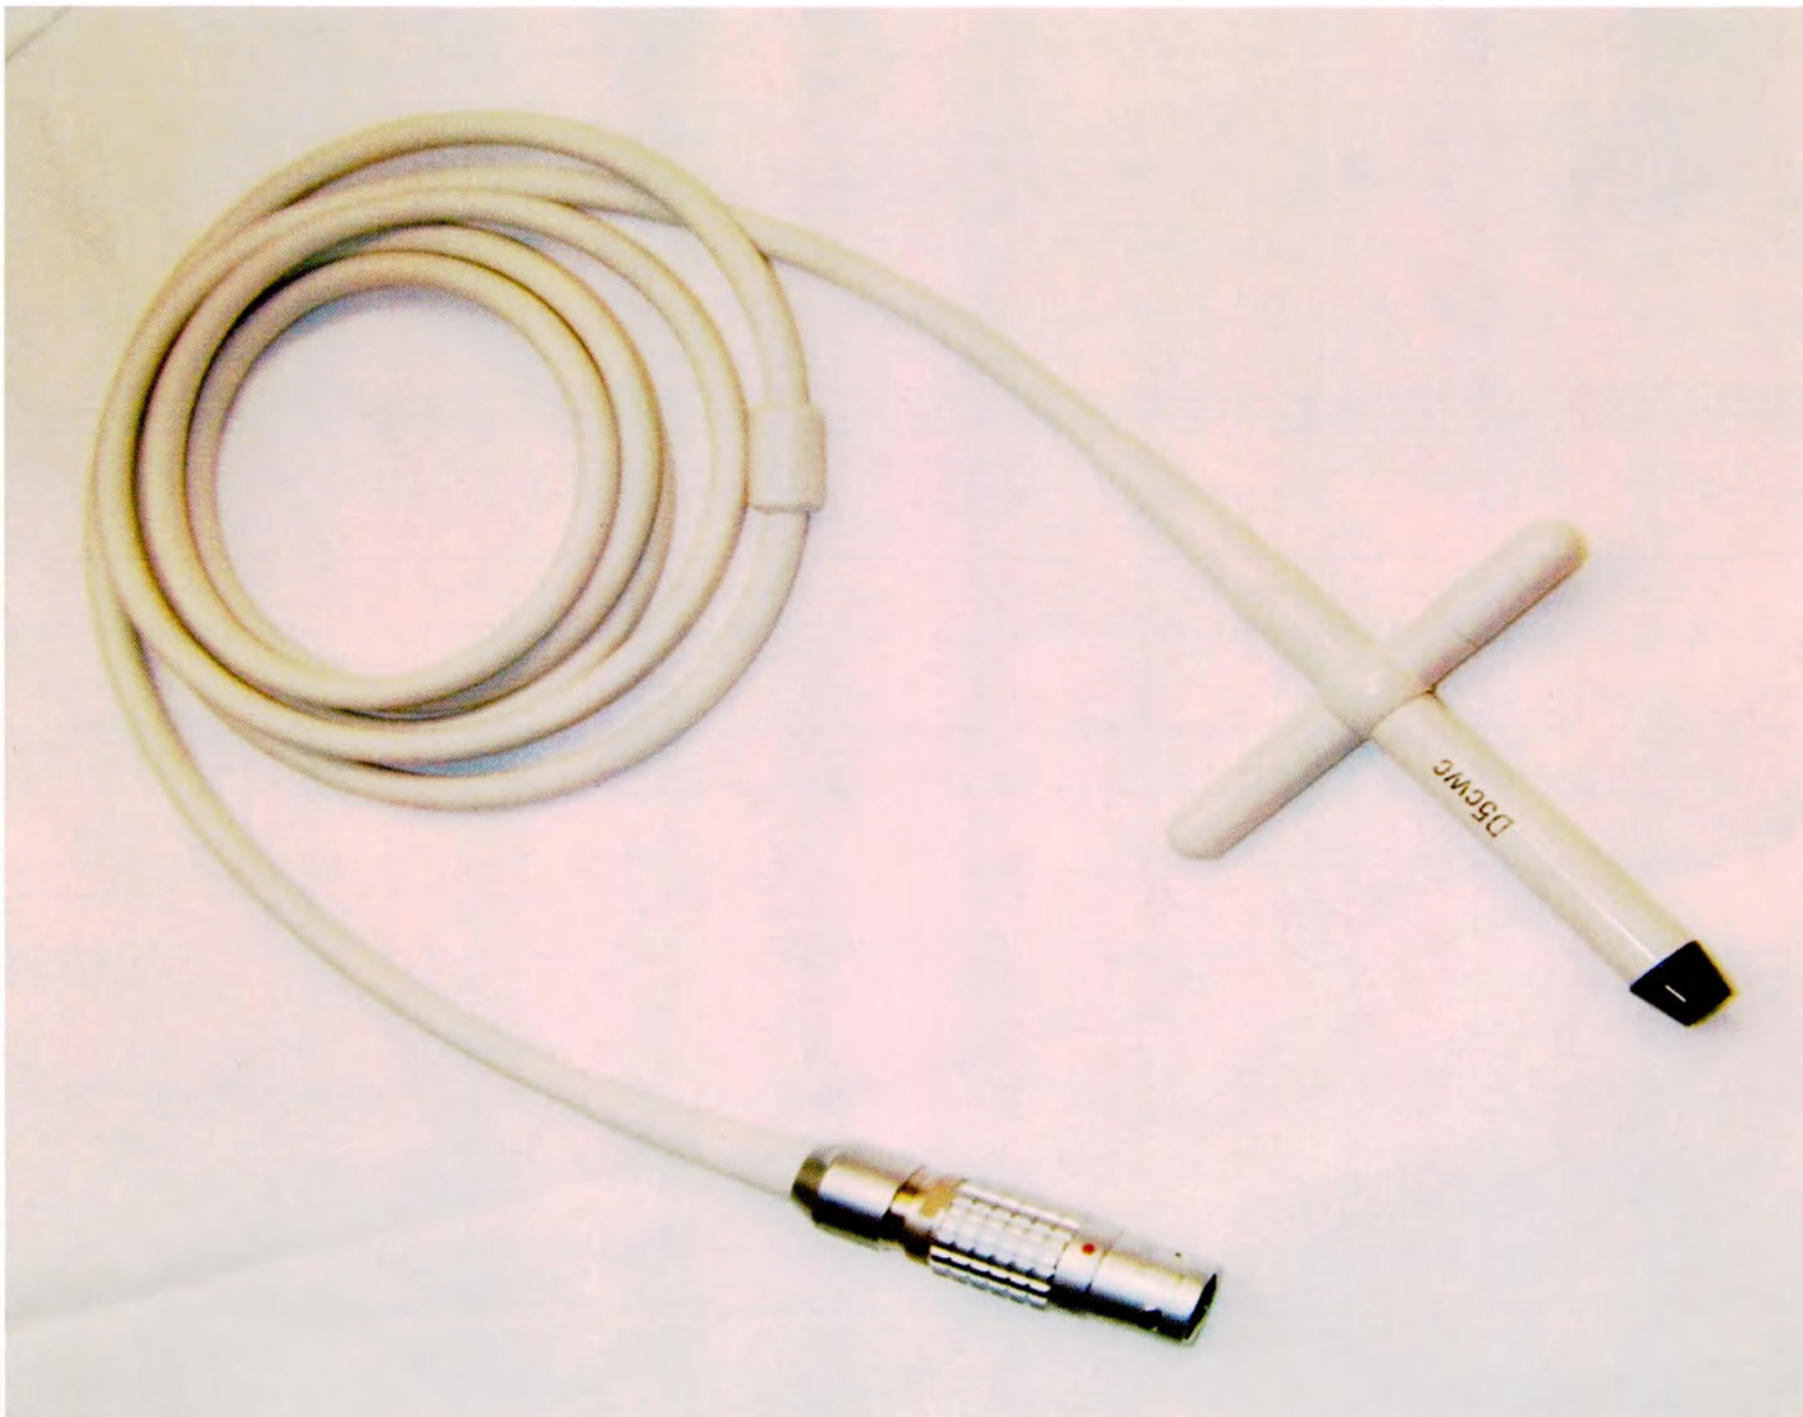


17. Датчик карандашный (волновой) D5cwc, РУ № ФСЗ 2010/08784;



18. Датчик карандашный (волновой) D2tcd, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости).;

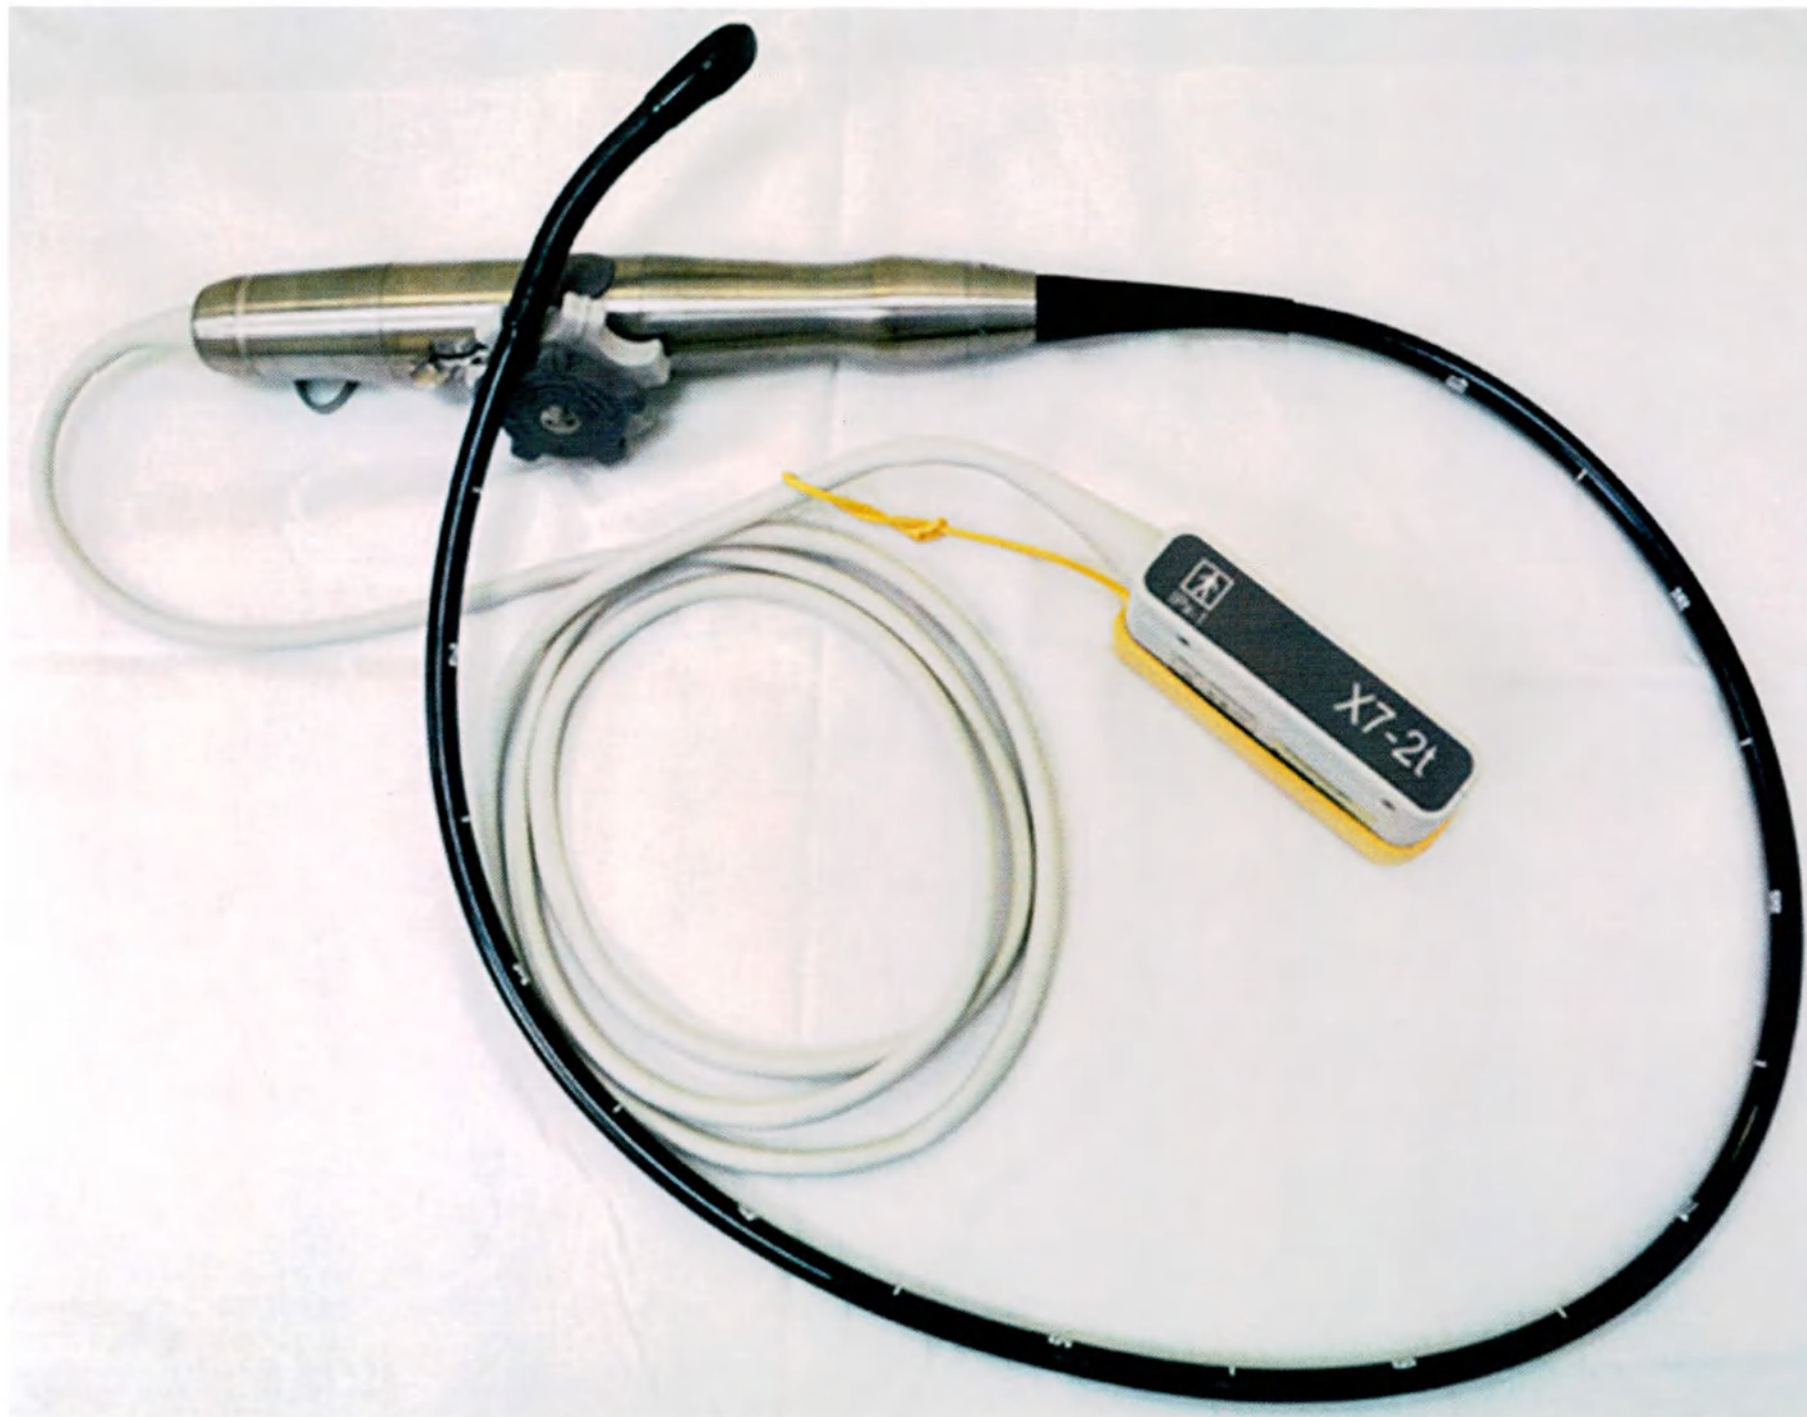

19. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X7-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости);

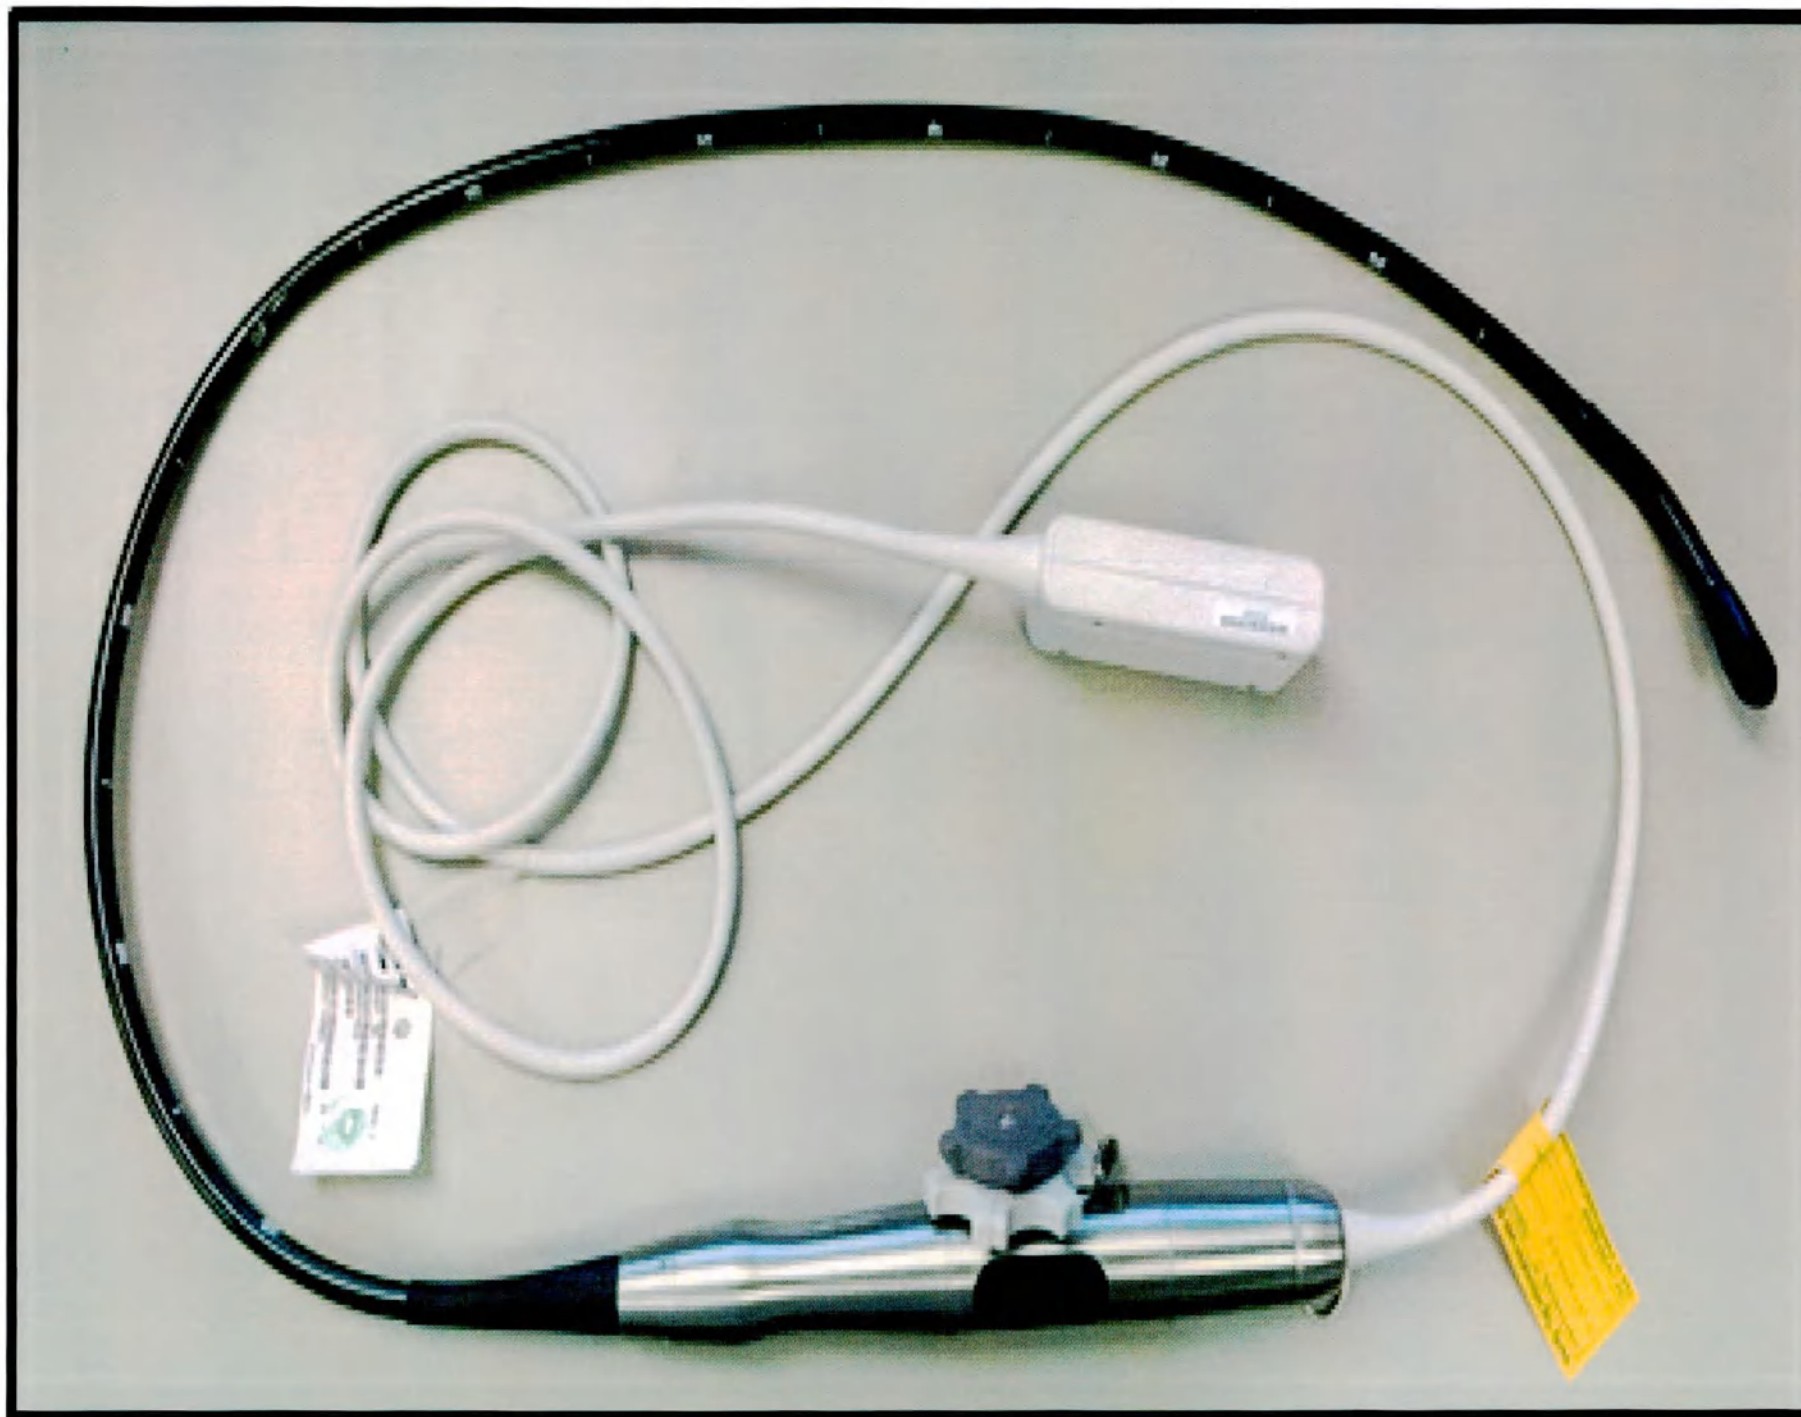

20. Датчик с фазированной (векторной) матрицей X8-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784 – не более 15 шт. (при необходимости)..



21. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для взрослых – не более 15 шт. (при необходимости).



22. Кабель ЭКГ с 3 отведениями и разъемами (IEC) для детей – не более 15 шт. (при необходимости).



23. Кабель вспомогательного входного сигнала – не более 15 шт. (при необходимости).




24. Кабель ЭКГ, длина не более 3 м – не более 15 шт. (при необходимости). – не более 15 шт. (при необходимости).



25. Шнур питания европейский 4,28 м – не более 5 шт.



26. Адаптер переменного тока – не более 5 шт. (при необходимости).

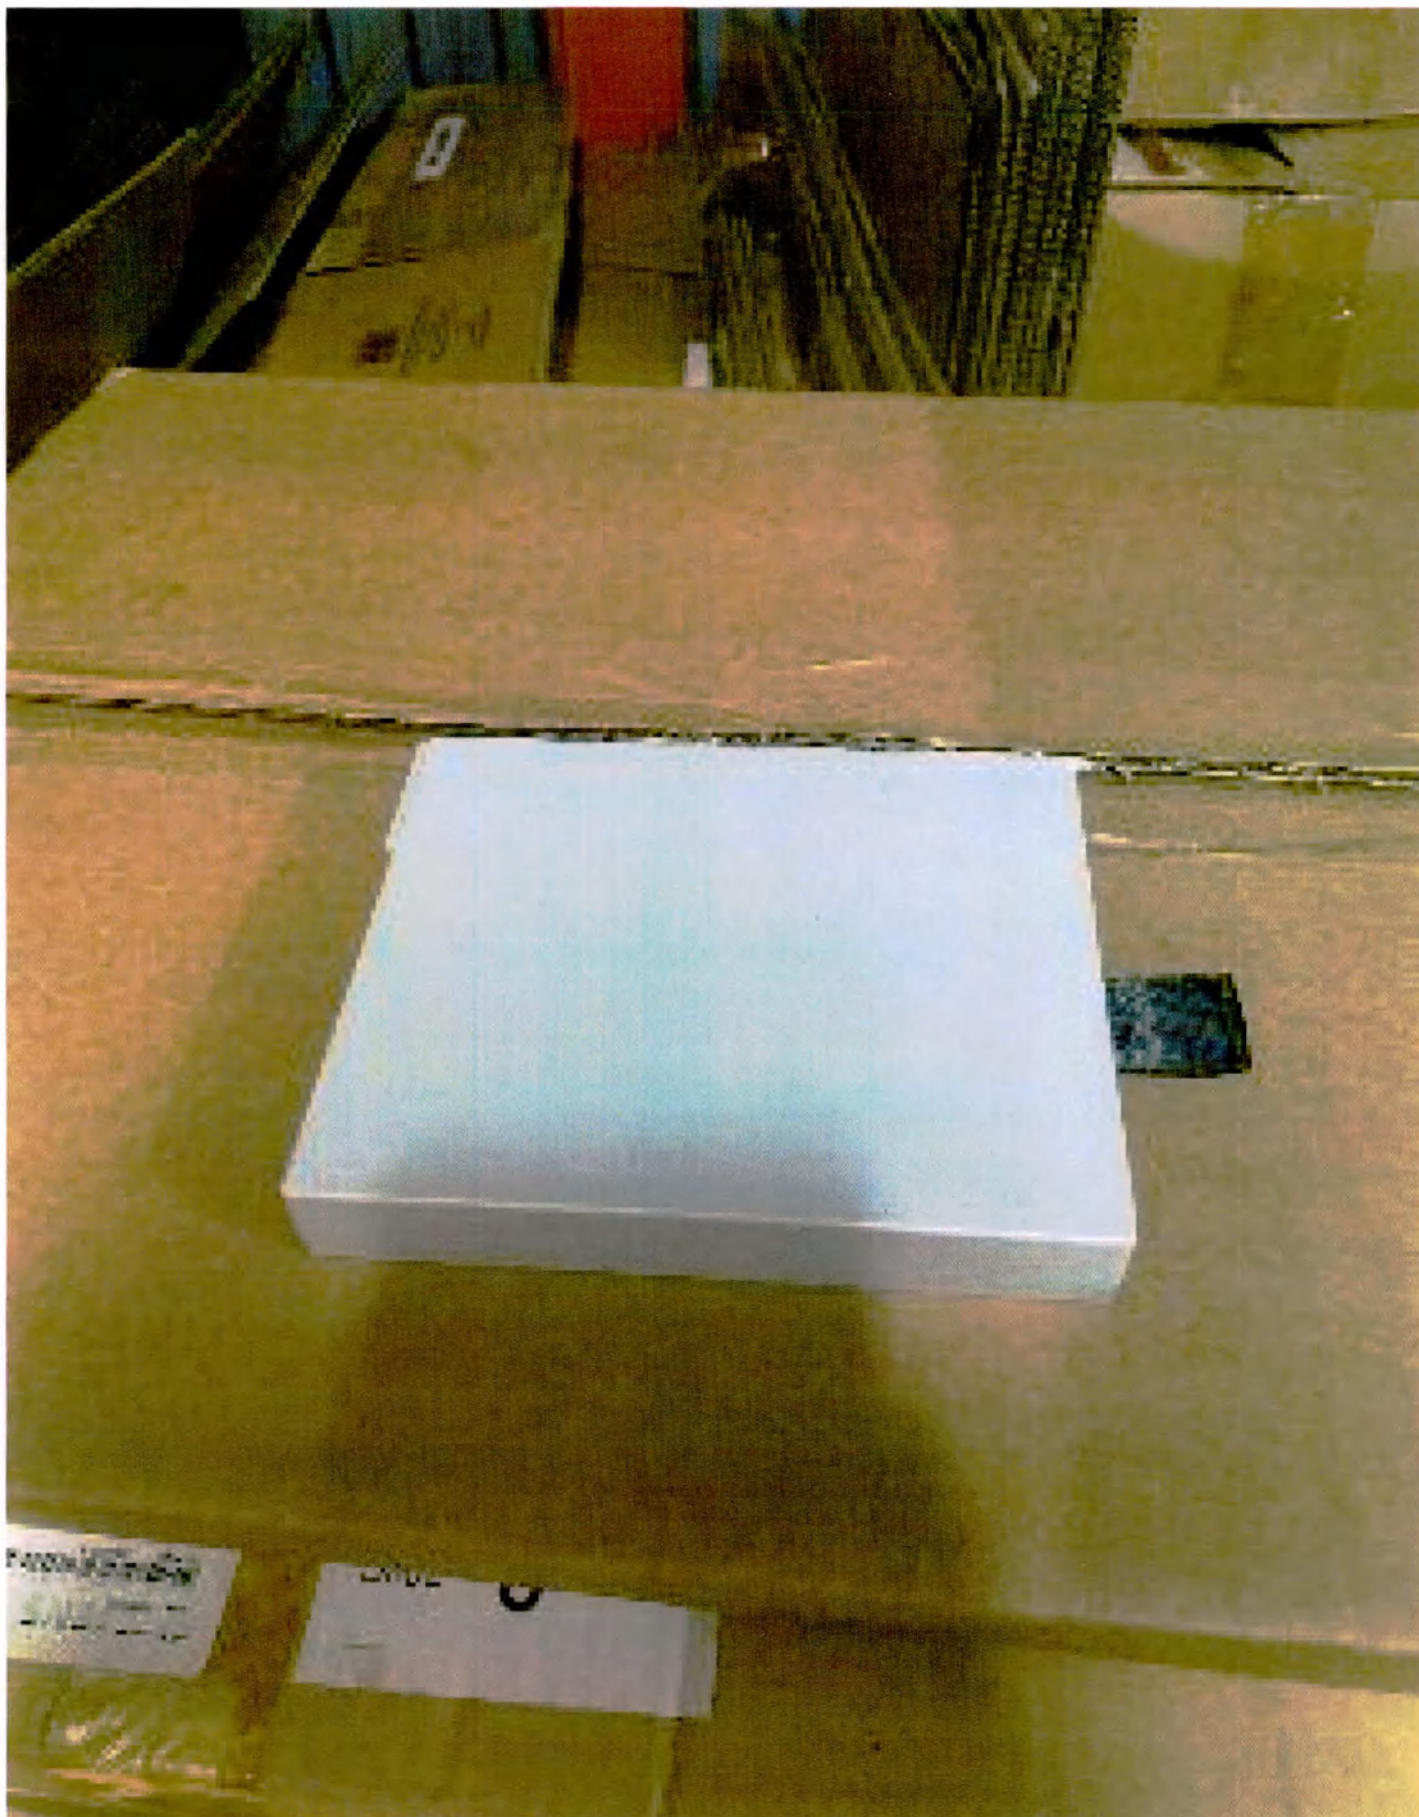

27. Литий- ионный аккумулятор – не более 5 шт. (при необходимости).



28. Ванночка для дезинфекции чреспищеводных датчиков – не более 5 шт. (при необходимости).



Руководство
пользователя

Русский

Ультразвуковые системы серии 5000 Compact

PHILIPS

29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1

Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; носители и/или на бумажном носителе.



Руководство
пользователя
(интегрированное)

Русский

Полная 1.1

Программное обеспечение углубленного количественного анализа QLAB

PHILIPS

29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1

Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях в составе: 29.1 Руководство пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.2 Дополнение к руководству пользователя для медицинского изделия на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.; 29.3 Программное обеспечение Углубленного количественного анализа QLAB на электронном носителе и/или на бумажном носителе – 1 шт.;



30 Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе




30. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе

Принадлежности:



1. Переключатель ножной – 1 шт.

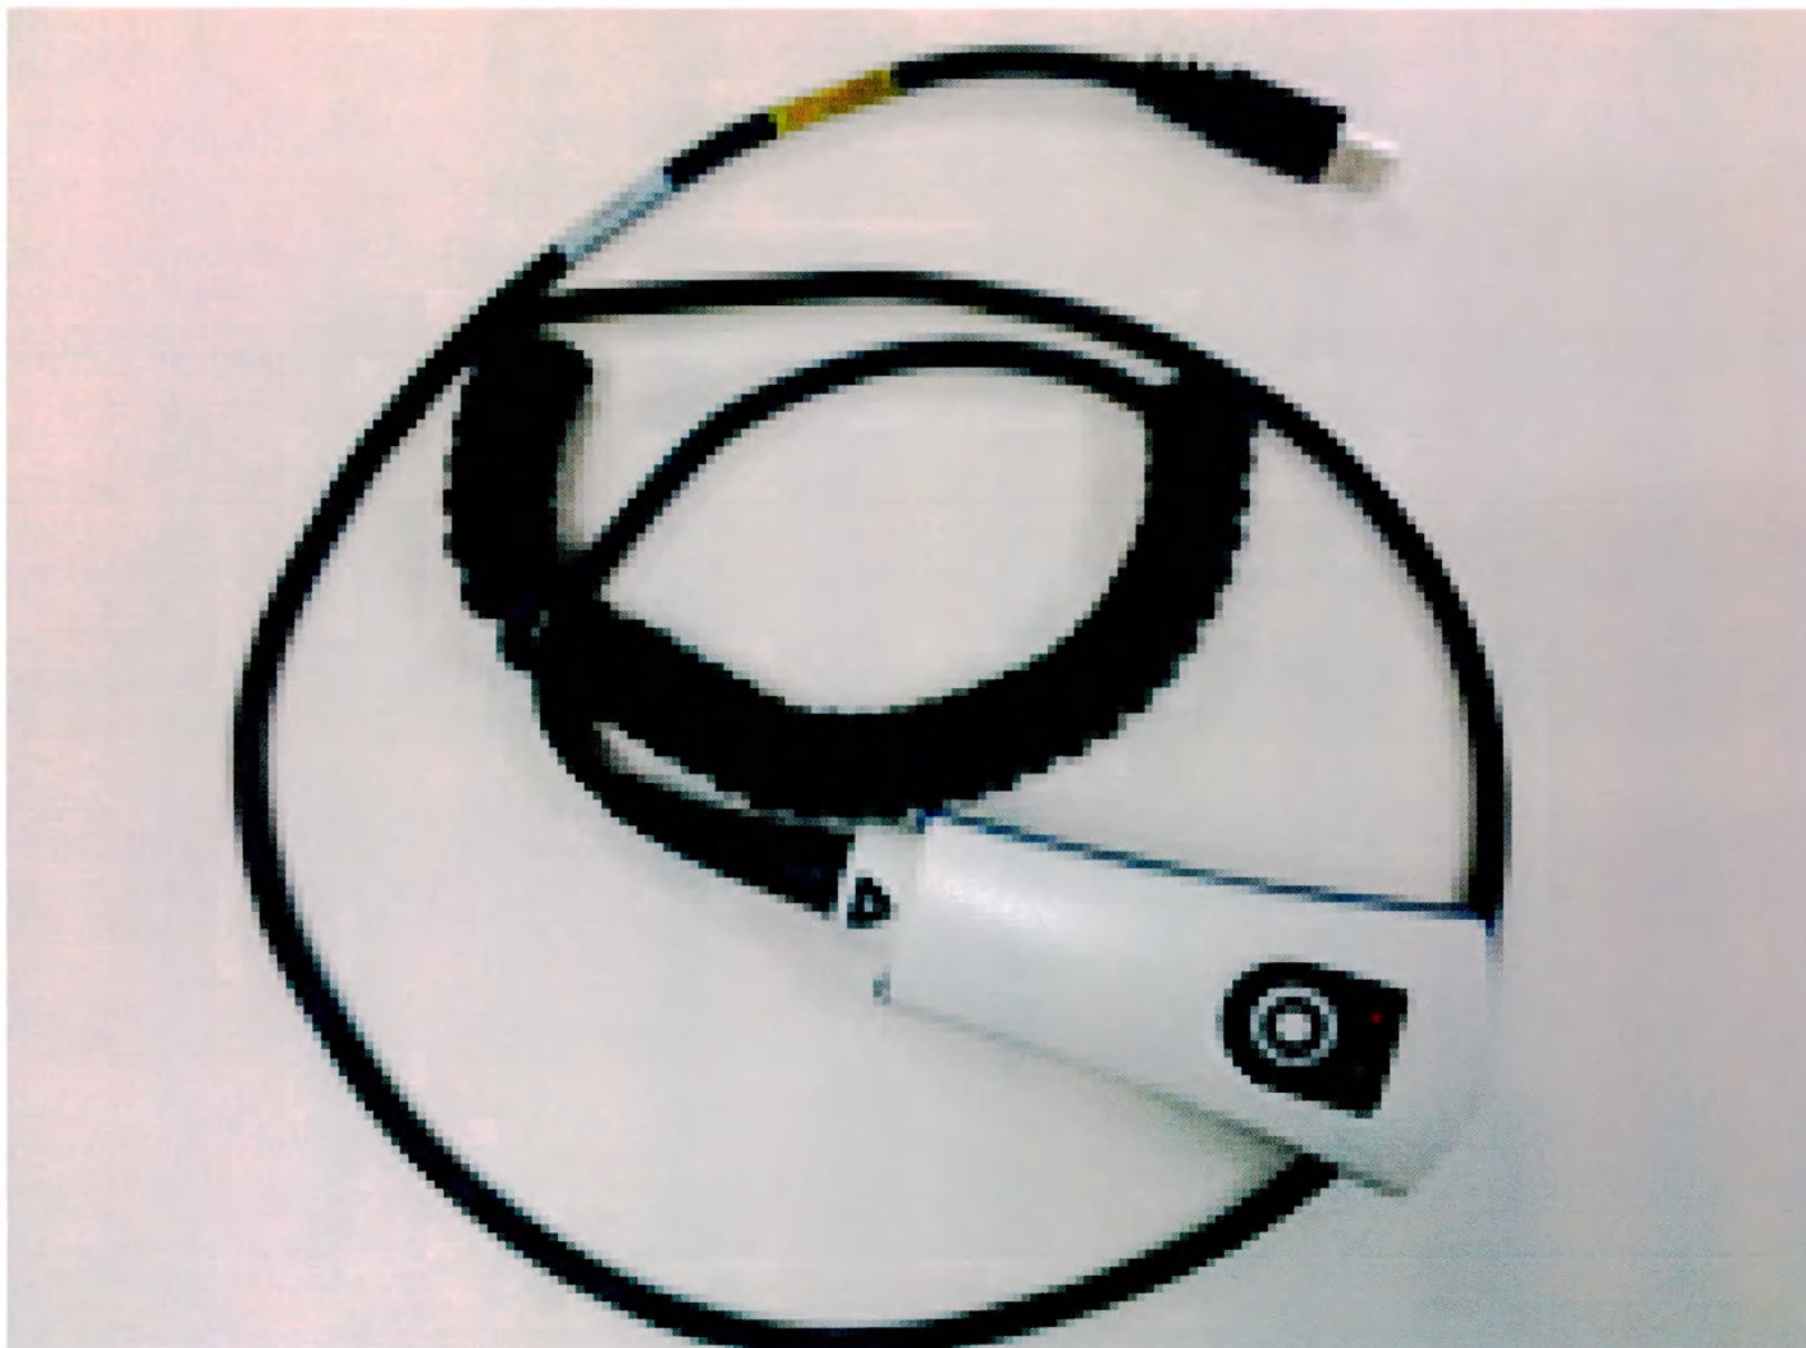

2. Сканнер штрихкода – 1 шт.



3. Кабель вывода видеосигнала – не более 5 шт.




4. Кабель ЛС сетевой – не более 5 шт.



5. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D898MD, производства компании Sony – не более 5 шт



6. Органайзер для кабелей датчиков – 2 шт.

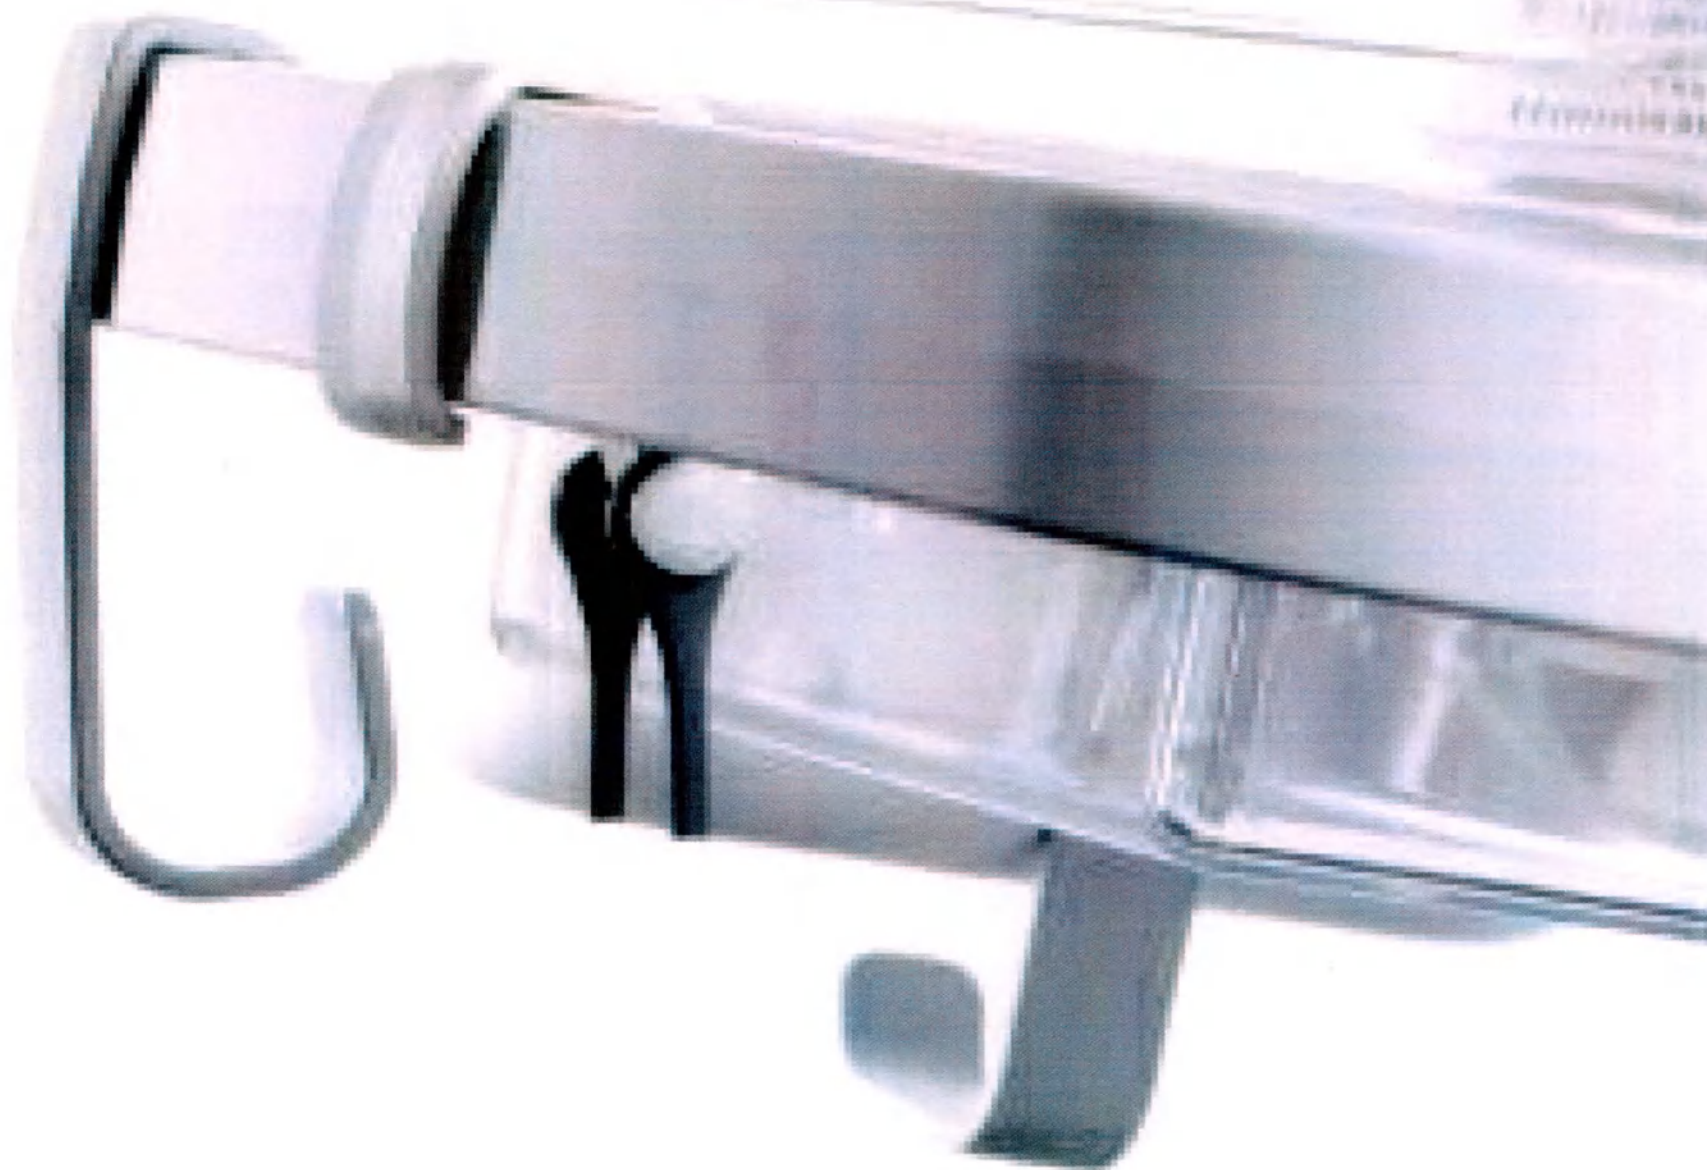

7. Захваты кабелей – 2 шт.



8. Отсек для хранения – 1 шт.



Фото транспортной упаковки.

Производитель	[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]
Место производства	[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]
Медицинское изделие	[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]
Вариант исполнения	[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]
	
Предупреждения и знаки опасности	
Номинальный режим работы	Информация доступна на основном лейбле
Серийный номер	Информация доступна на основном лейбле
Дата производства	Информация доступна на основном лейбле
Регистрационное удостоверение	[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]
Label P/N: XXXXXXXXXXXXX 	

Пример макета русскоязычной маркировки для систем 5300, 5500, 5500 CV

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
148 листа (ов)

