

Surgix

ophthalmic surgical products

ООО ООО "Серджикс"
129164, город Москва,
Маломосковская ул, д. 16 стр. 1
Тел. +7 (495) 543-74-73,
E-mail: info@surgix.ru
Сайт: www.surgix.ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Серджикс»

Мышалов М.С.

«28» марта 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™
производства

HOYA Medical Singapore Pte. Ltd.
(ХОЯ Медикал Сингапур Пте. Лтд.), Сингапур

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ multiSert™,
в составе:

- 1 Линза XY1-SP (оптическая сила + 20,0 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1-SP без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1-SP в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

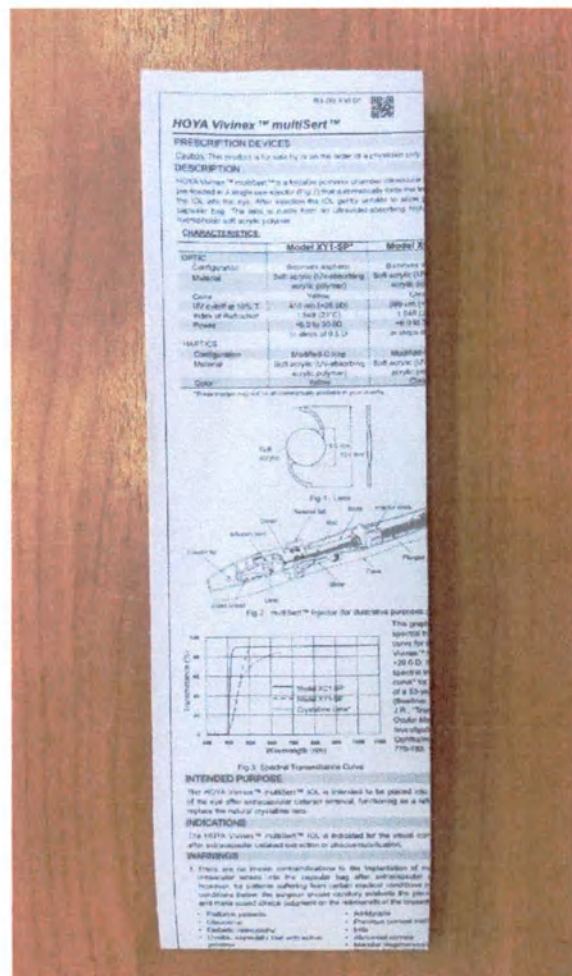

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ multiSert™,
в составе:

- 1 Линза XC1-SP (оптическая сила + 20,5 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.



а) Инжектор с линзой XC1-SP без упаковки




б) Инжектор с линзой XC1-SP в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)




в) Личная карточка пациента без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)

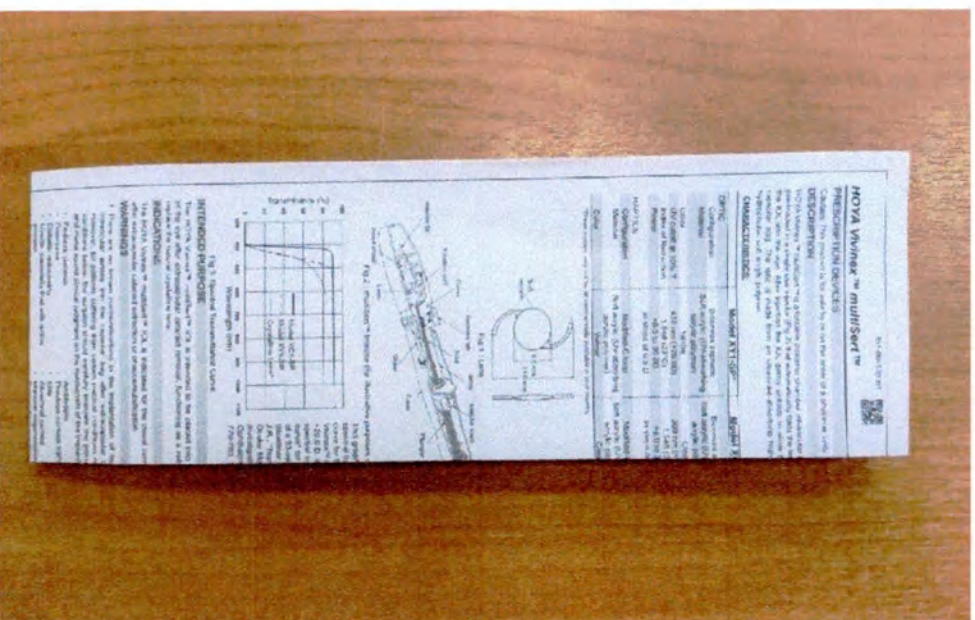

г) Инструкция по применению без упаковки

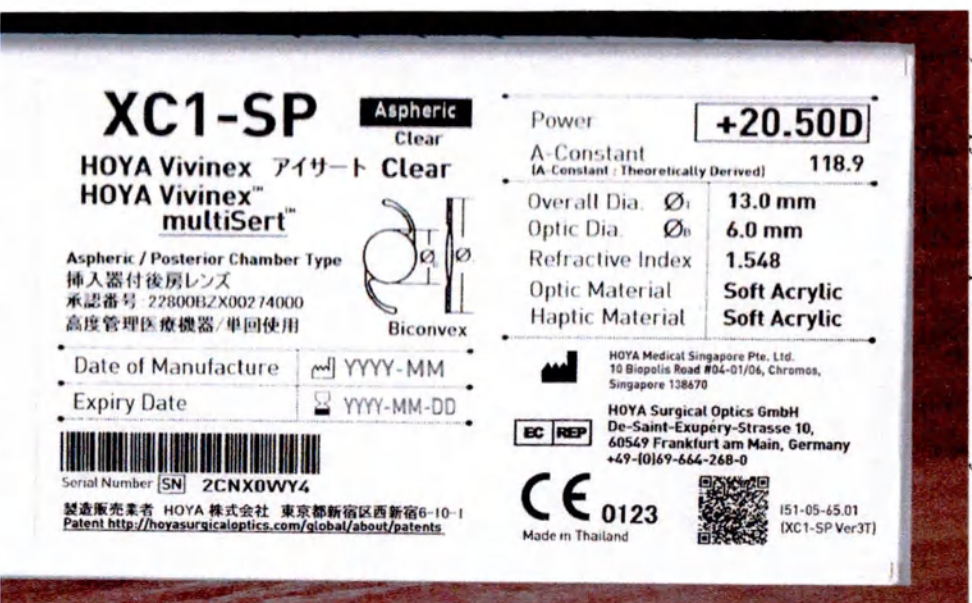

е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT2 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 1,00 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT2 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT2 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

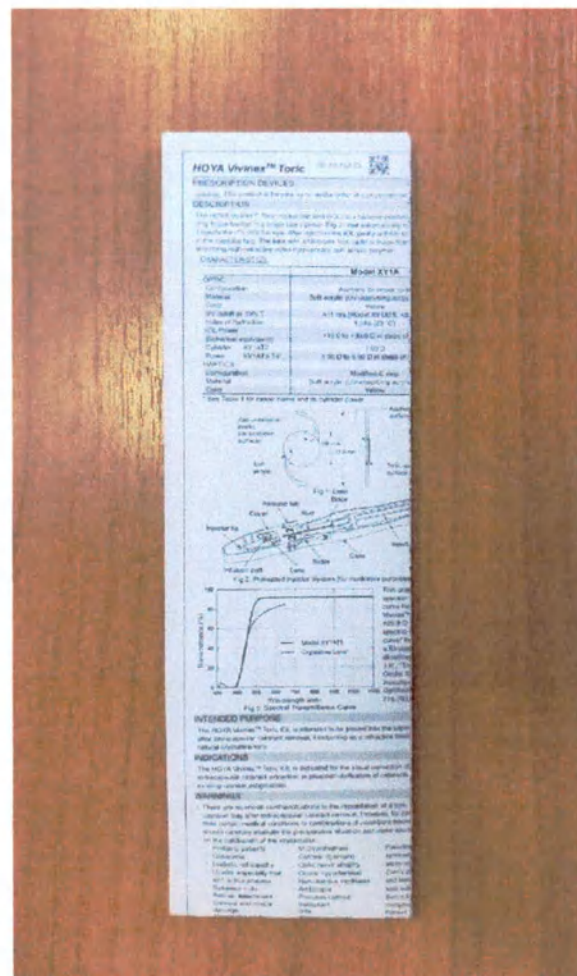

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT3 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 1,50 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT3 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT3 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

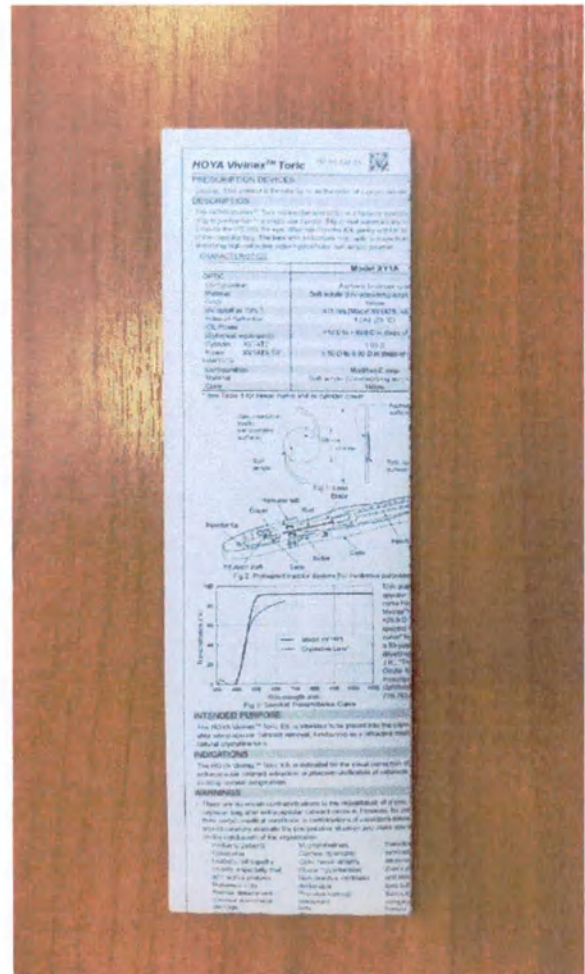

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)




е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT4 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 2,25 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT4 без упаковки

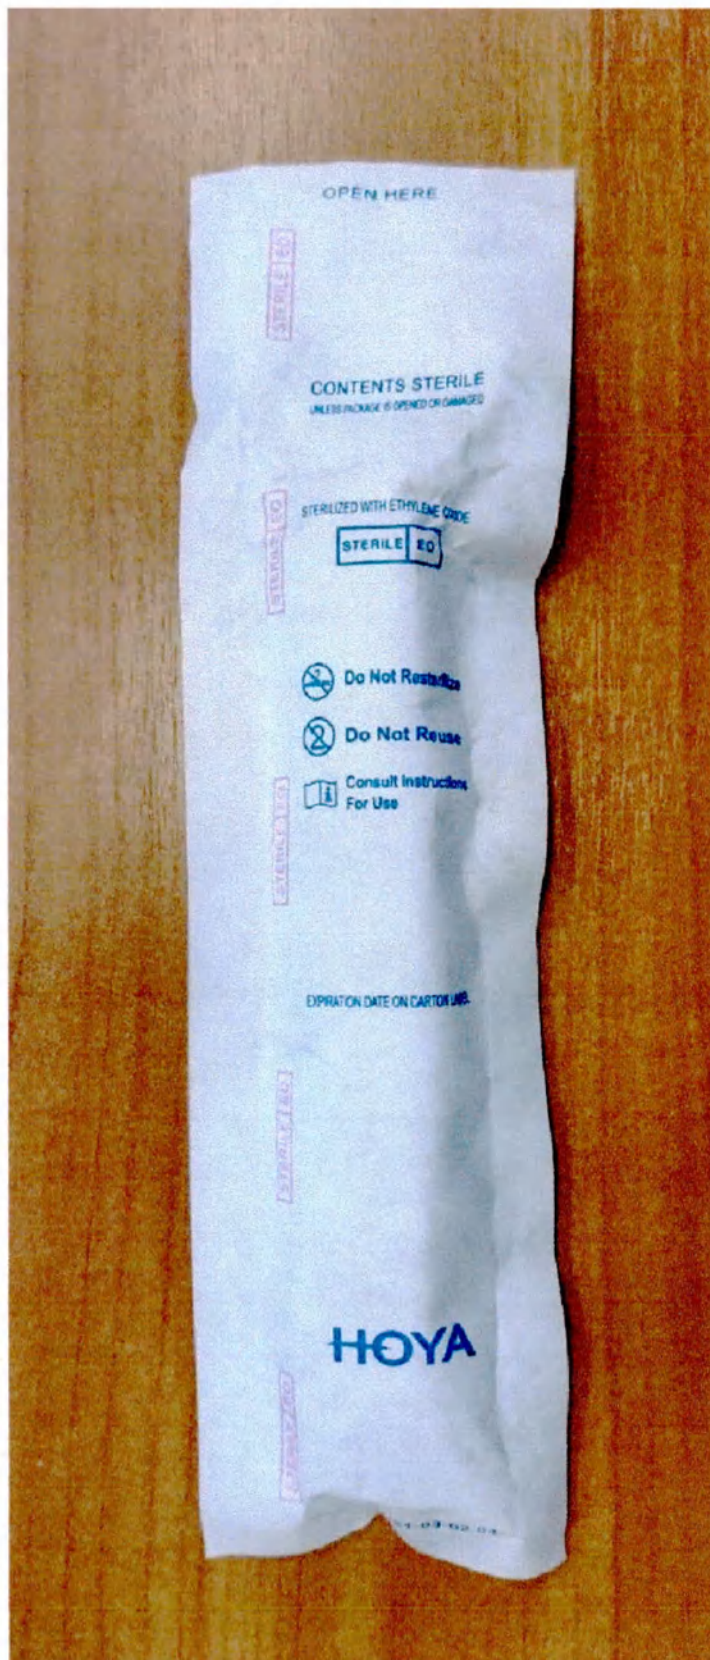

б) Инжектор с линзой XY1AT4 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

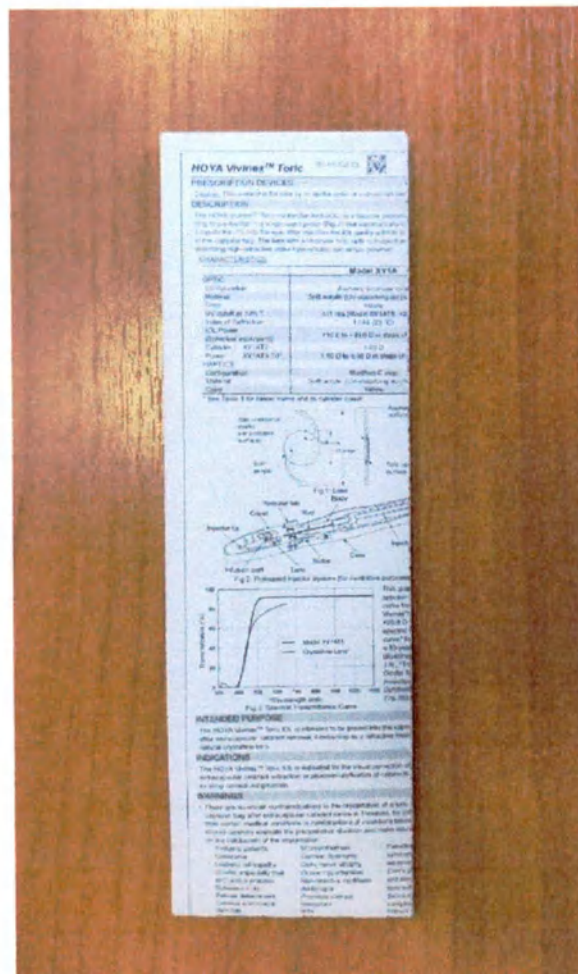

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT5 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 3,00 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT5 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT5 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

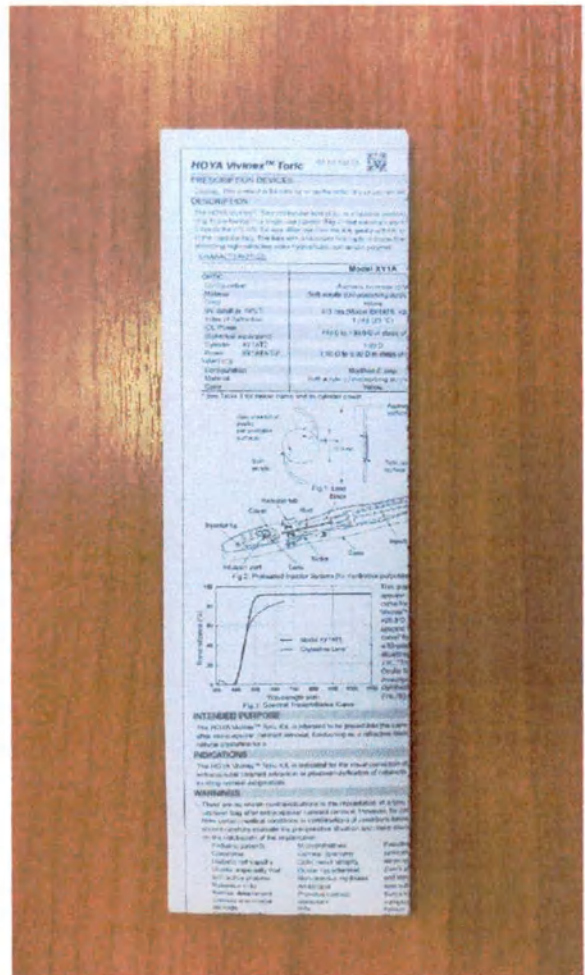

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT6 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 3,75 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT6 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT6 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

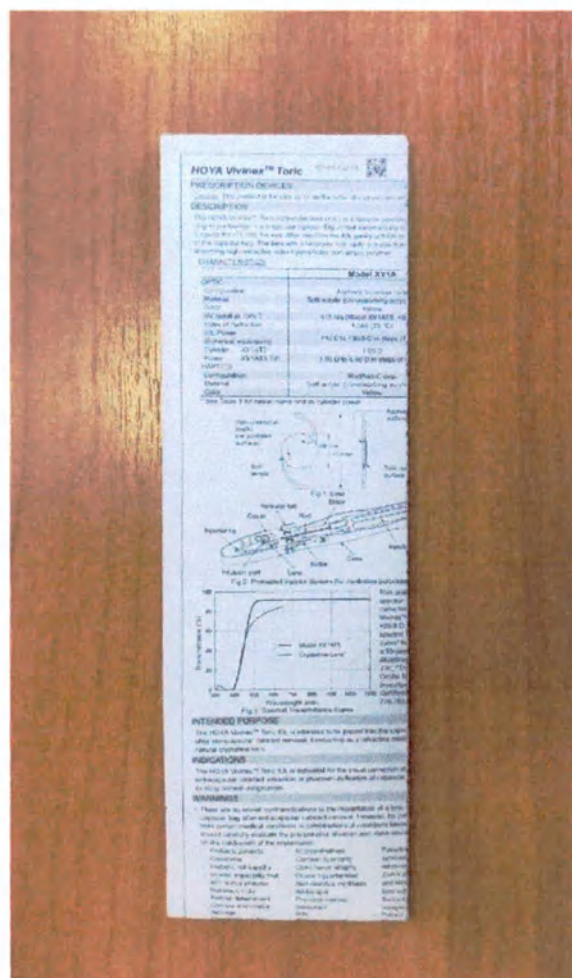

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT7 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 4,50 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT7 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT7 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

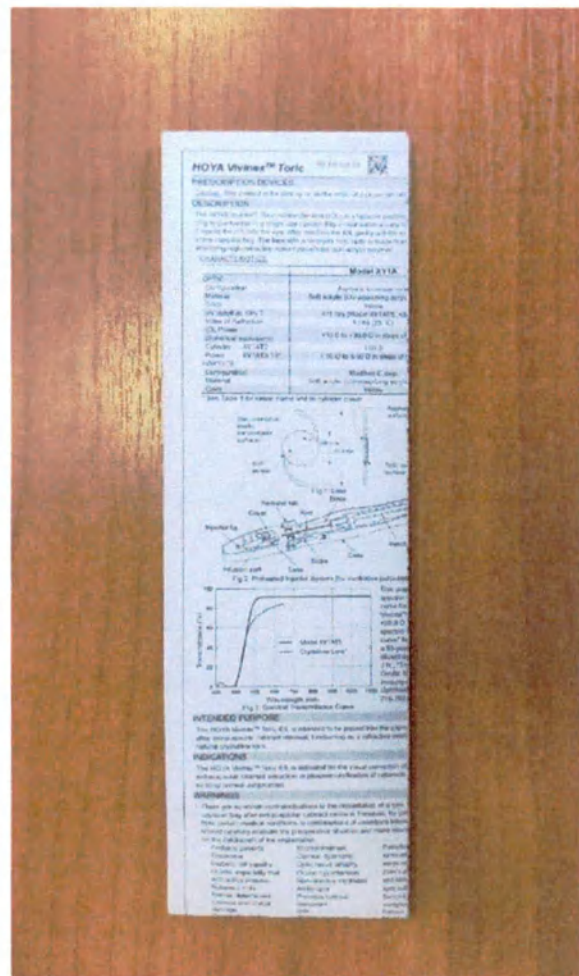

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT8 (оптическая сила + 21,0 дптр; цилиндр 5,25 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT8 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT8 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

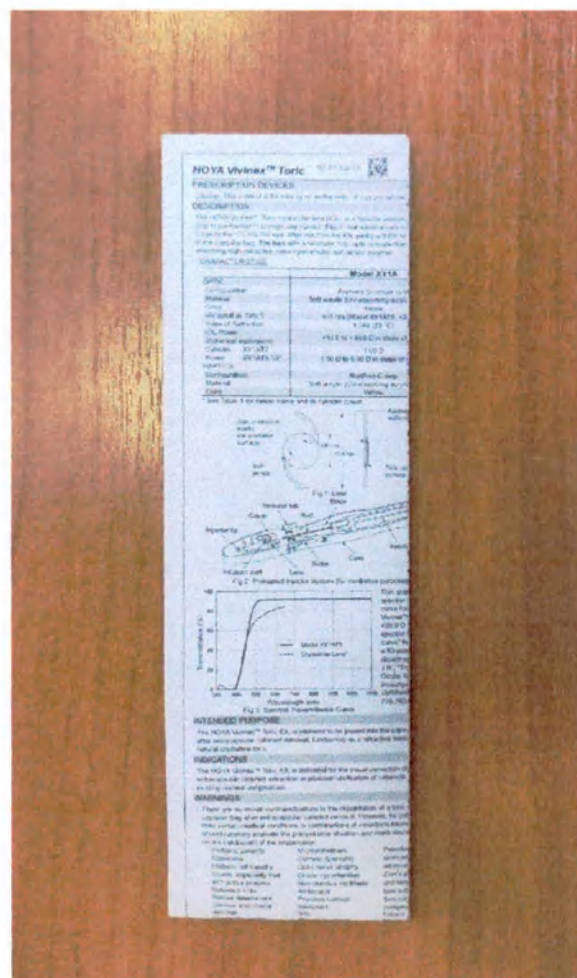

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ Toric,
в составе:

- 1 Линза XY1AT9 (оптическая сила + 20,5 дптр; цилиндр 6,00 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1AT9 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1AT9 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запакованном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

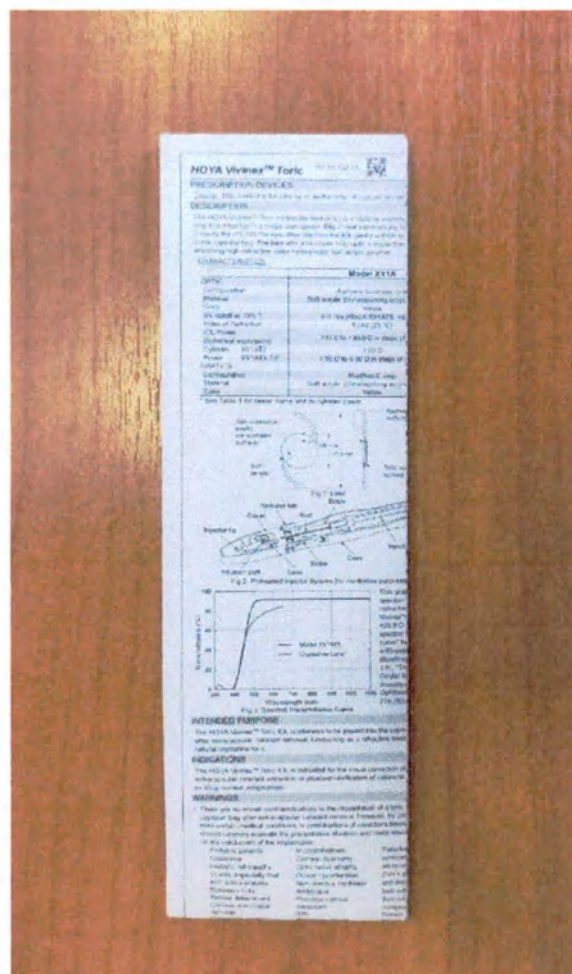

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ iSert,
в составе:

- 1 Линза XY1 (оптическая сила + 11,5 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XY1 без упаковки



б) Инжектор с линзой XY1 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

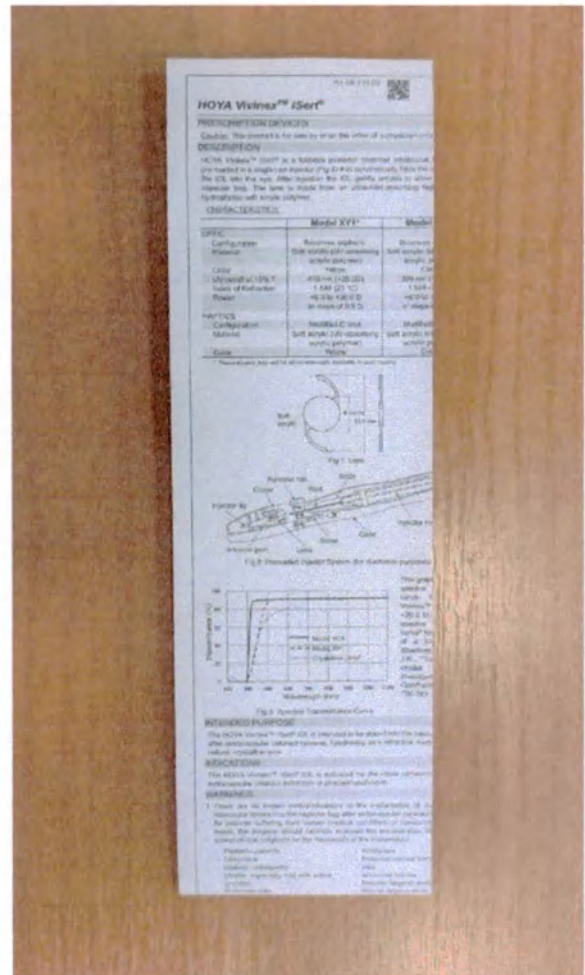

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™,
вариант исполнения: Устройство для интраокулярной коррекции зрения HOYA Vivinex™ iSert,
в составе:

- 1 Линза XC1 (оптическая сила от +15,0 дптр) – 1 шт.
- 2 Инжектор – 1 шт.
- 3 Личная карточка пациента – 1 шт.
- 4 Инструкция по применению – 1 шт.




а) Инжектор с линзой XC1 без упаковки



б) Инжектор с линзой XC1 в барьерной системе для стерилизации (стерильном запаянном пакете)



в) Личная карточка пациента без упаковки

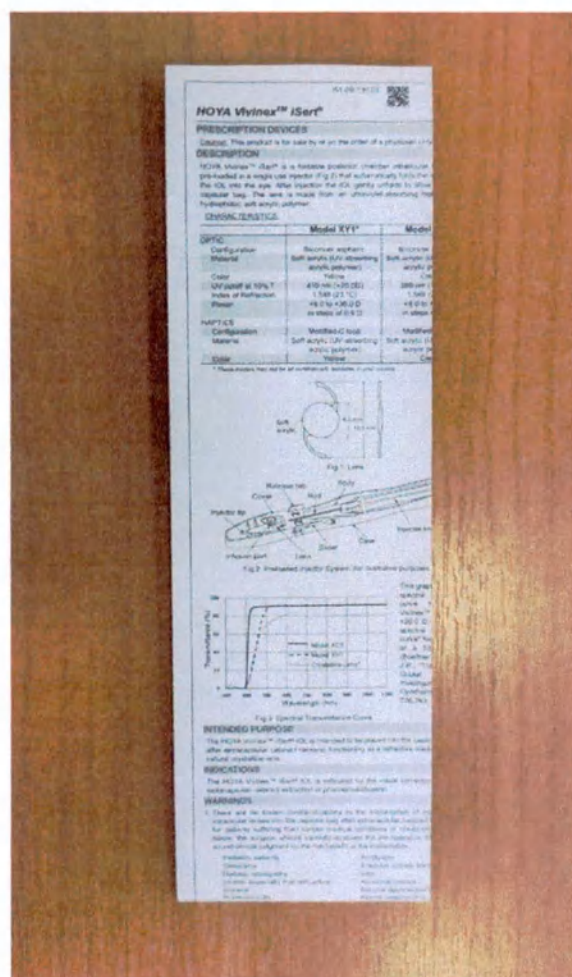

г) Инструкция по применению без упаковки



д) Изделие во вторичной упаковке (коробке из картона)



е) Маркировка вторичной упаковки (коробки из картона)

Прошнуровано, пронумеровано
Количество 25 лист 16

Генеральный директор
ООО "Серджикс"
Мышалов М.С.

