

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО НПК «РЭЛСИБ»



Фотография

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский
RELSIB WT50 по ТУ 9441-043-57200730-2016 с
принадлежностями

**Комплектность поставки термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями в соответствии с таблицей**

Таблица

Наименование изделия	Обозначение документа	Количество на изделие, шт.
Термометр медицинский RELSIB WT50 по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями		
СОСТАВ:		
1 Термометр медицинский RELSIB WT50	РЭЛС.941241.001	1
2 Батарея литиевая	CR2032	1
3 Ключ для смены батареи	РЭЛС.757512.003	1
4 Программное обеспечение THERMOMETER SMART FAMILY для мобильных устройств на виртуальном носителе (с операционной системой Android версии не ниже 4.3 или iOS версии не ниже 7.1 с поддержкой беспроводного интерфейса Bluetooth 4.0)		1
5 Руководство по эксплуатации (по требованию приобретателя)	РЭЛС.941241.001 РЭ	1
6 Инструкция по применению	РЭЛС.941241.001 И1	1
7 Инструкция по работе с «Приложением к мобильному устройству»	РЭЛС.941241.001 И2	1
8 Методика поверки (по требованию приобретателя)	МП 2017-004.6	1
9 Гарантийный талон	РЭЛС.754463.017	
ПРИНДЛЕЖНОСТИ:		
1 Маркеры	РЭЛС.715531.009	комплект из 6-и маркеров различных цветов
2 Футляр	РЭЛС.421941.009	1
3 Коробка картонная (индивидуальная упаковка)	РЭЛС.323229.017	1

**Комплектность поставки термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**



**Фотография термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**

Вид с лицевой стороны



**Фотография термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**

Вид с обратной стороны



**Фотография термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями с открытым колпачком**



Маркировка наружной части термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями



Маркировка футляра термометра медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями



Инструкция по применению

Инструкция по работе с «Приложением к мобильному устройству»



Гарантийный талон на термометр медицинского RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями

Термометр медицинский RELSIB WT50

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор Термометра RELSIB WT50 и выражаем уверенность, что он вам понравится.

НПК «Рэлсиб» - изготовитель гарантирует соответствие Термометра RELSIB WT50 техническим характеристикам, изложенным в Инструкции по применению, а также требованиям ТУ 9441-043-57200730-2016.

Настоящая гарантия действует в течение двух лет с момента начального приобретения Термометра.

Гарантия действует при условии, что прибор приобретён на территории Российской Федерации, Казахстана или Беларуси.

Гарантийный ремонт предоставляется при предъявлении чётко и правильно заполненного Гарантийного талона и дефектного изделия.

Гарантийный бесплатный ремонт не распространяется:

- на Термометр с механическими дефектами;
- при попадании внутрь посторонних предметов, в том числе воды, насекомых, продуктов их жизнедеятельности;
- при выявленных попытках ремонта прибора неуполномоченными на это лицами;
- в случае его неправильной эксплуатации;
- при неправильном транспортировании и хранении.

(Лицевая сторона)

Термометр медицинский RELSIB WT50

Гарантийный талон

Термометр медицинский RELSIB WT50 З.н. _____ изготовлен и принят _____ дата, подпись и клеймо ОТК

Дата продажи _____

Наименование и печать продавца _____

Подпись представителя продавца _____ м.п. _____

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания:

Дата: _____

Наименование сервисного центра: _____

Характер дефекта: _____

Вид ремонта: _____

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания:

Дата: _____

Наименование сервисного центра: _____

Характер дефекта: _____

Вид ремонта: _____

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания:

Дата: _____

Наименование сервисного центра: _____

Характер дефекта: _____

Вид ремонта: _____

Гарантийный ремонт производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных сервисных центрах. Адреса сервисных центров можно узнать на сайте изготовителя: www.рэлсибздоровье.рф, www.relsibhealth.com, e-mail: support@relsibhealth.com

Изготовитель: 630082 Россия, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60; Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, а/я 167

(Оборотная сторона)

**Маркеры к термометру медицинскому RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**




**Батарея литиевая CR2032 к термометру медицинскому RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**





**Футляр к термометру медицинскому RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016 с принадлежностями**

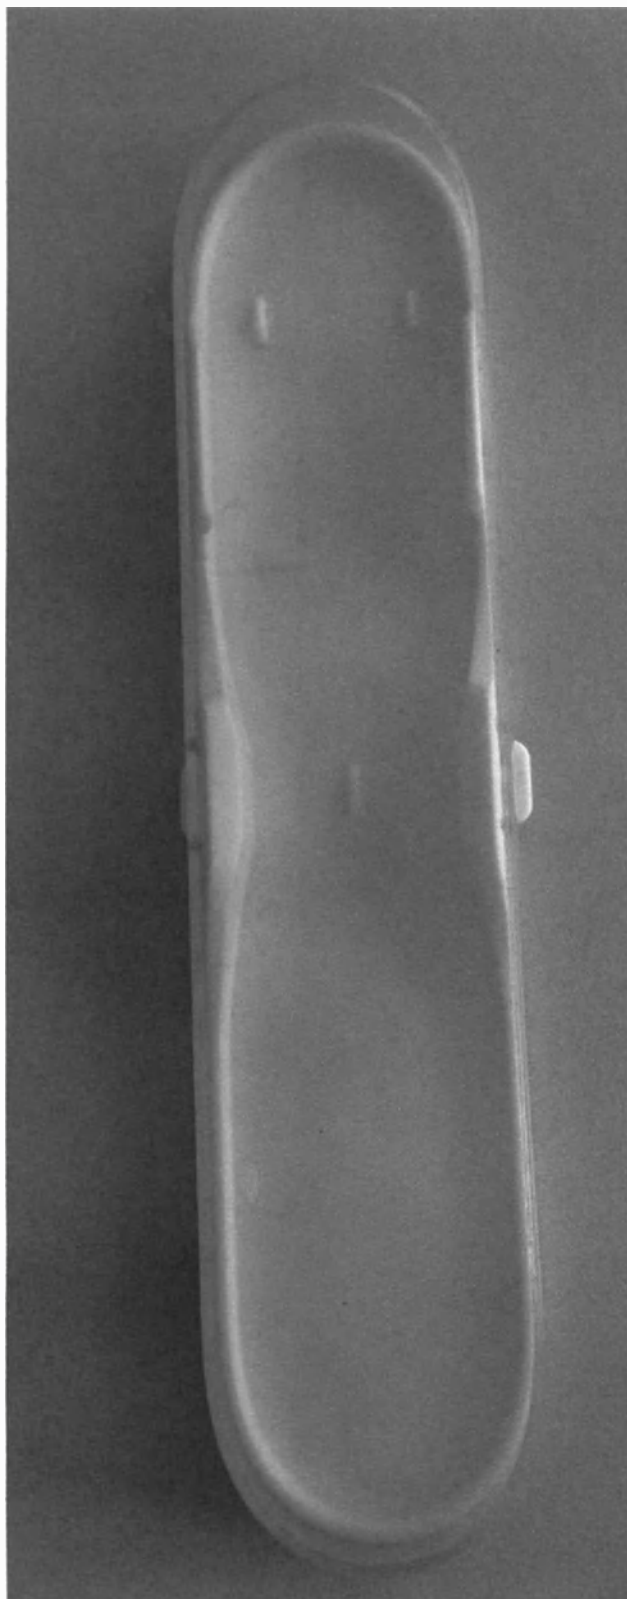



Производитель:

ООО Научно–производственная компания «РЭЛСИБ»

Юридический адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60, корп. 1, пом. 62

Адрес производства: г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60 (Корпус № 1) на 1 и 3 этаже (на поэтажном плане в техпаспорте 1 этаж №1, 3 этаж №-№ 1-20)

Для писем: 630110, г. Новосибирск, а/я 167

тел. (383) 319–64–01; 319–64–02; факс. (383) 319–64–00

chif@relsib.com

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Должность: директор

Подпись И.Г. Ландочкин /И.Г. Ландочкин

15 августа 2019г.

