

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ПСА общий-Ультима” (комплект 1)
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2023 г.



ПСА общий-Ультима

Набор реагентов
 для иммунохемилюминесцентного оп-
 тического определения концентрации общего
 простат-специфического антигена
 в сыворотке крови
 для автоматических ИХЛА-а
 серии Ультим

ИНСТРУКЦИЯ ПО

Хранить при температуре 2-8°C Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 26°C не более 10 суток		
Дата изготовления 2023-05-15 Дата выдачи паспорта 2023-05-15 Срок годности наборов до 2024-05-15		
Состав	Внешний вид	Результаты контроля
Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами, серия 1	Пластиковый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1 шт	Пластиновый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1 шт (соответствует)
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ, серия 1	Коплоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 2,5 мл	Коплоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 2,5 мл (соответствует)
Конъюгат, концентрат, серия 1	Жидкость синего цвета, 1 фл., 5,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 5,5 мл (соответствует)
Раствор для разведения конъюгата (РЮ), серия 1	Жидкость синего цвета, 1 фл., 7,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 7,5 мл (соответствует)
Калибровочный образец 1 (K1), серия 1	Жидкость светло-зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость светло-зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Калибровочный образец 2 (K2), серия 1	Жидкость зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 1 (KO1), серия 1	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 2 (KO2), серия 1	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0	Жидкость светло-желтого цвета, 1

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 1 (1)
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
15.05.2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 1 (2)
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«15» 05 / 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 6
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 7
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.

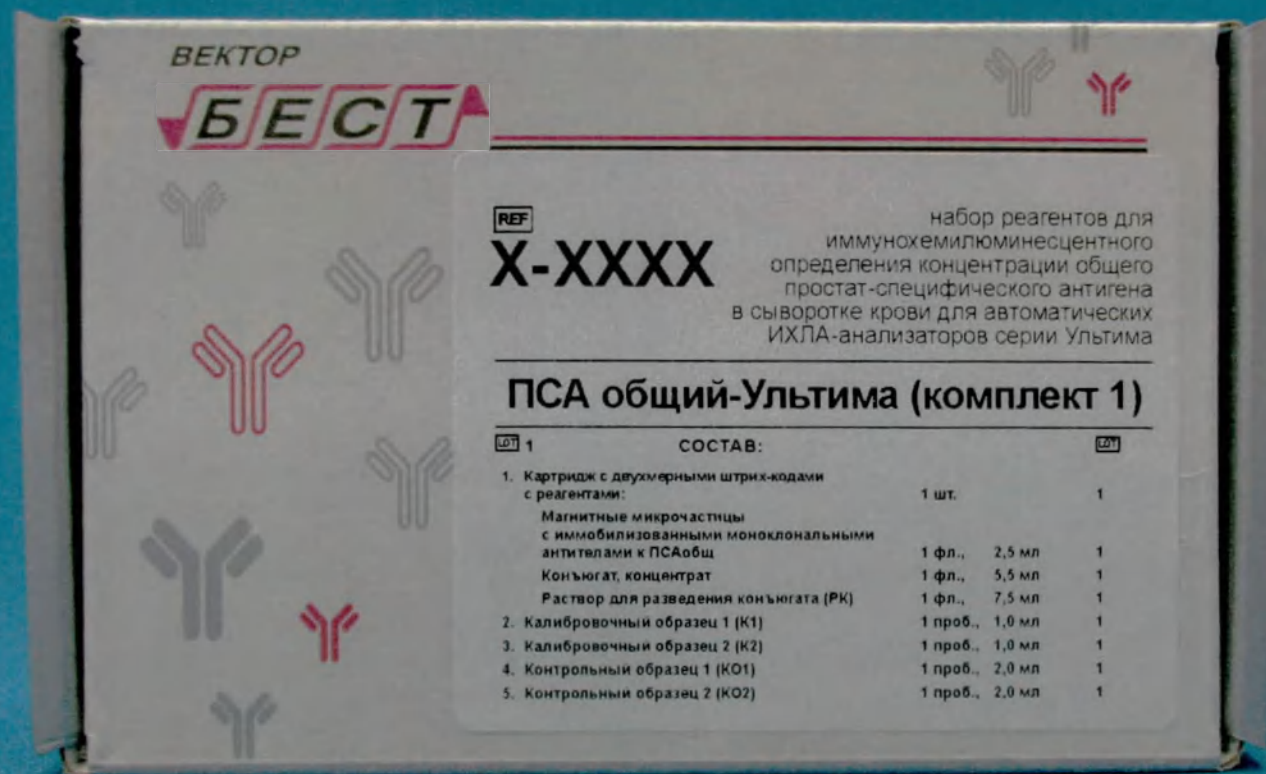

REF
X-XXXX

набор реагентов для
иммунохемилюминесцентного
определения концентрации общего
простат-специфического антигена
в сыворотке крови для автоматических
ИХЛА-анализаторов серии Ультима

ПСА общий-Ультима (комплект 1)

ЛОТ 1	СОСТАВ:	ЛОТ
1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами:	1 шт.	1
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ	1 фл., 2,5 мл	1
Конъюгат, концентрат	1 фл., 5,5 мл	1
Раствор для разведения конъюгата (РК)	1 фл., 7,5 мл	1
2. Калибровочный образец 1 (K1)	1 проб., 1,0 мл	1
3. Калибровочный образец 2 (K2)	1 проб., 1,0 мл	1
4. Контрольный образец 1 (KO1)	1 проб., 2,0 мл	1
5. Контрольный образец 2 (KO2)	1 проб., 2,0 мл	1

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2 (1)
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2 (2)
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13.05” 2023 г.

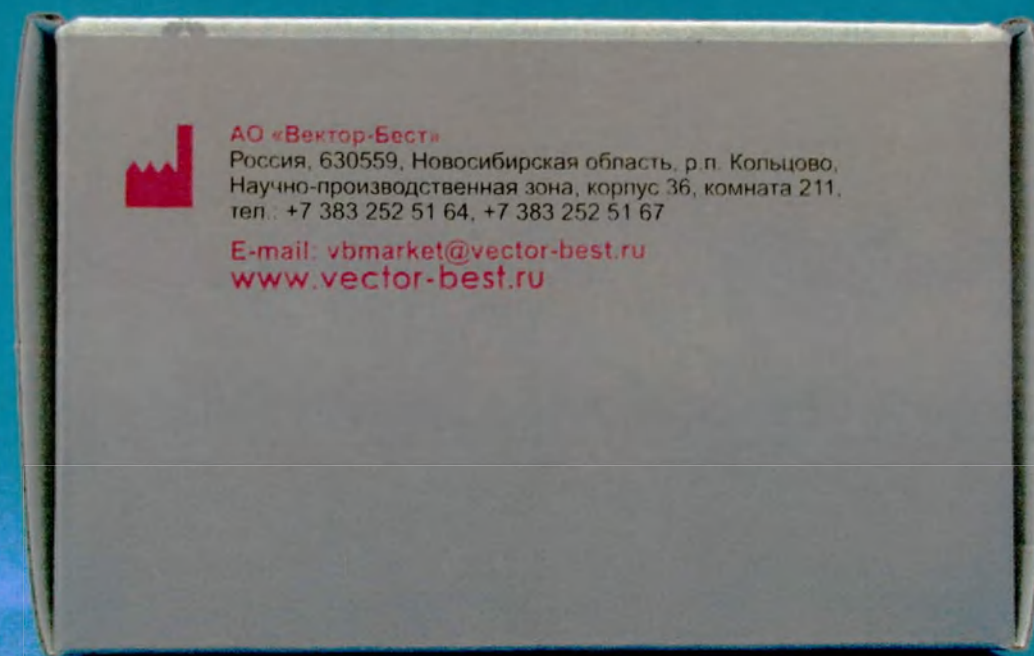

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ПСА общий-Ультима" (комплект 1)
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Ультима" (комплект 1) № 1 (1)
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 1 (2)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Ультима" (комплект 1) № 4
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 6
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 7
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



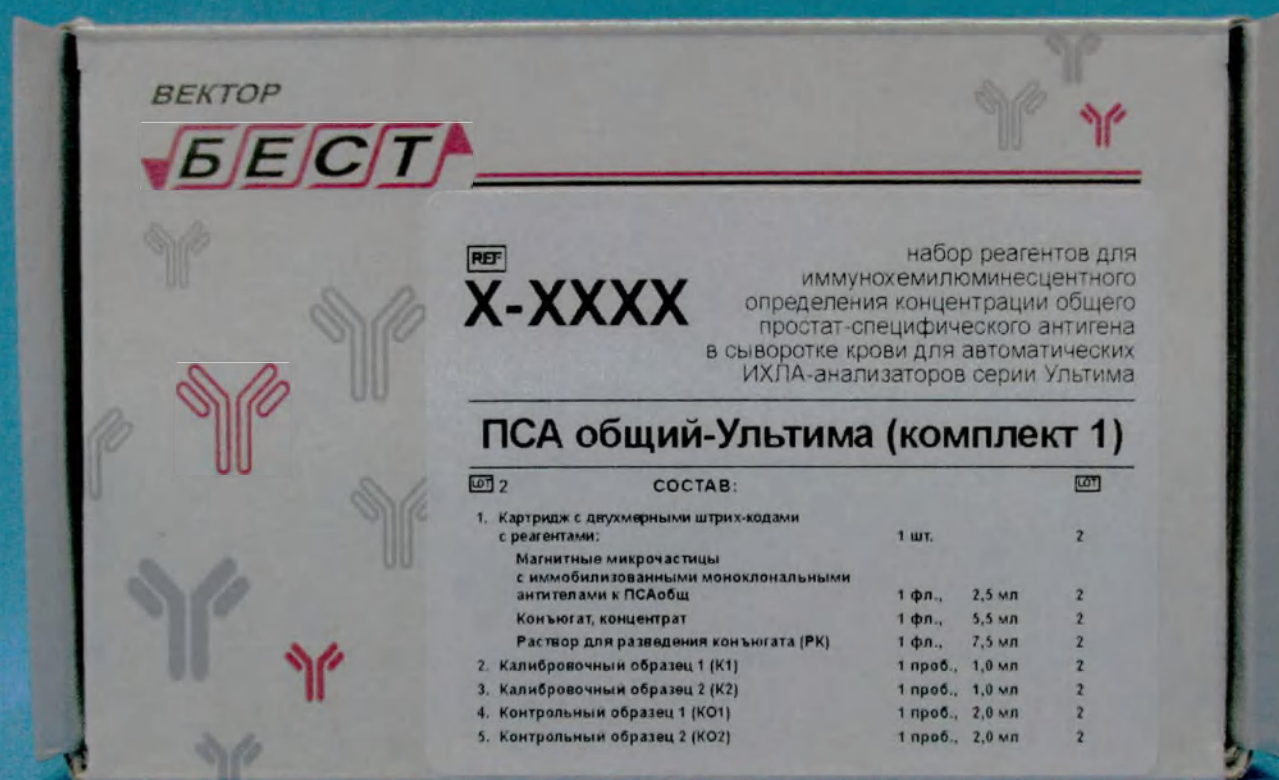

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2 (1)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 2 (2)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.

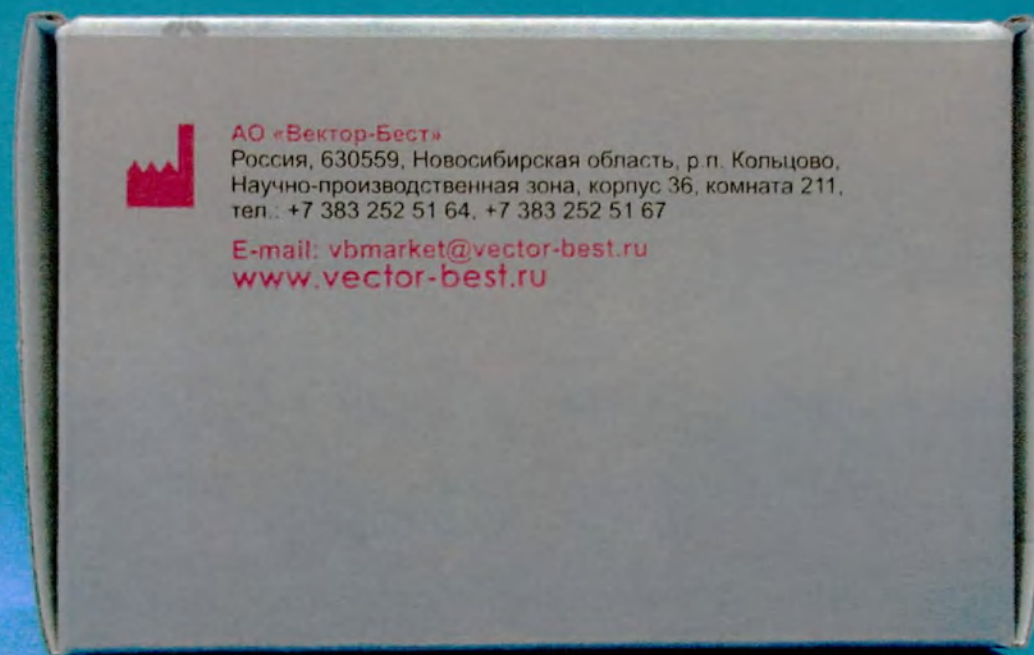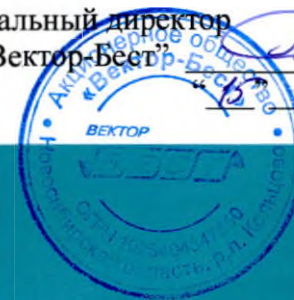

АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ПСА общий-Ультима” (комплект 2)
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1 (1)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1 (2)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.

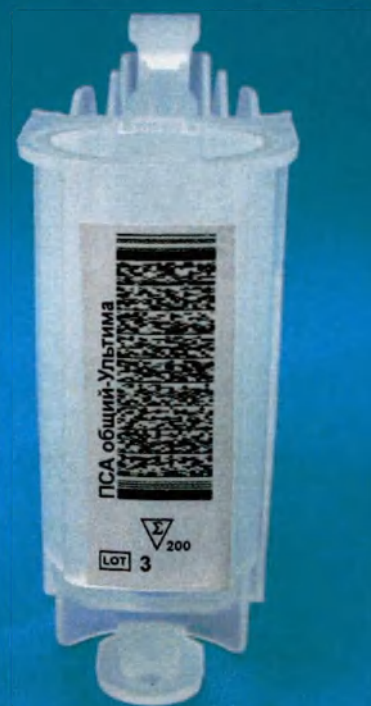

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Ультима" (комплект 2) № 4
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 6
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 7
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.

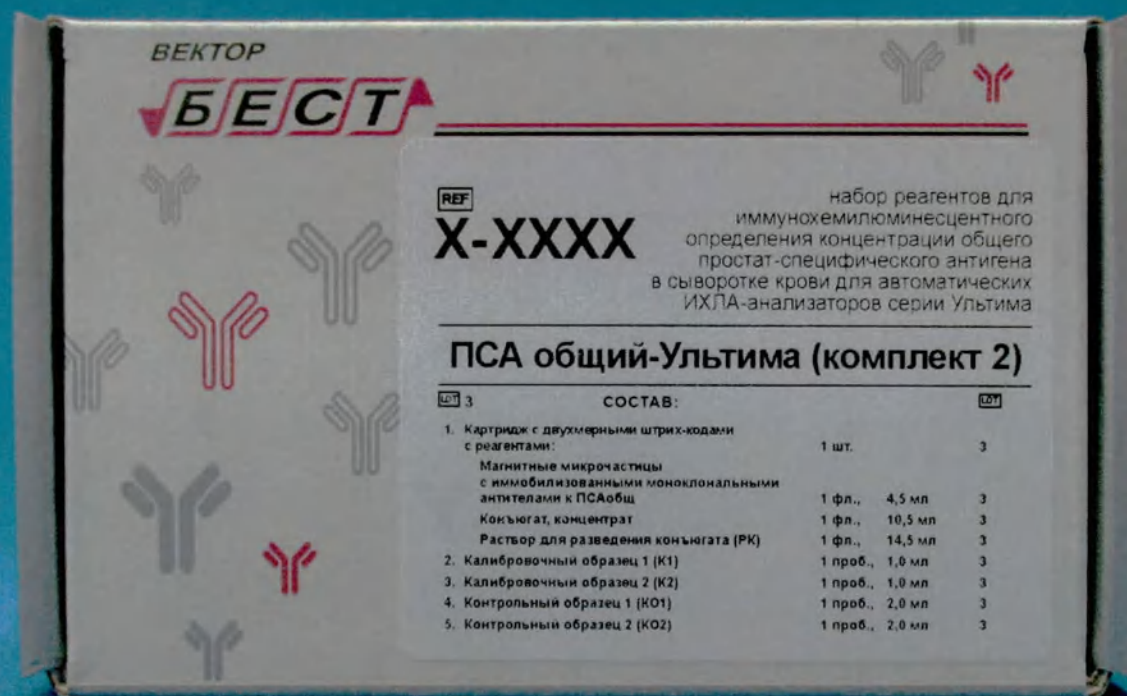

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2 (1)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2 (2)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.

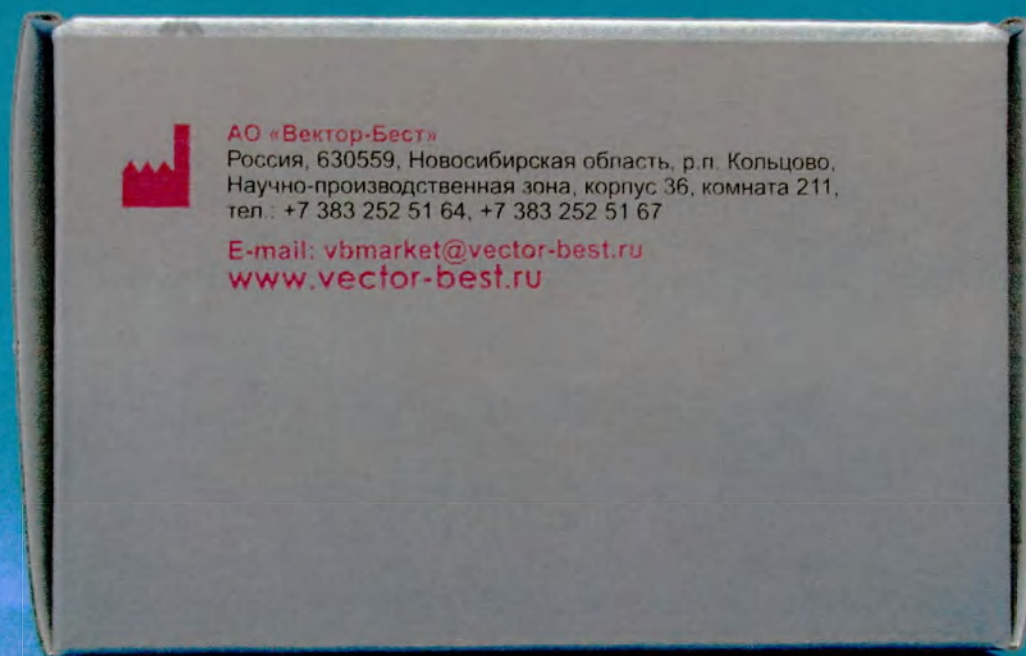

АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ПСА общий-Ультима" (комплект 2)
 серия 4

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2023 г.



ПСА общий-Ультима

Набор реагентов
 для иммунохемилюминесцентного определения
 концентрации общего
 простат-специфического антигена
 в сыворотке крови
 для автоматических ИХЛА-анализаторов
 серии Ультима

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хранить при температуре 2-8°C
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается
 транспортирование при температуре до 26°C не более 10
 суток.

Дата изготовления 2023-05-15
 Дата выдачи паспорта 2023-05-15
 Срок годности набора до 2024-05-15

Состав	Внешний вид	Результаты контроля
Карtridge с двухмерными штрих-кодами с реагентами, серия 4	Пластиковый cartridge с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1шт	Пластиковый cartridge с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1шт (соответствует)
Магнитные микрокапсулы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ, серия 4	Коллоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1фл., 4,5 мл	Коллоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1фл., 4,5 мл (соответствует)
Конъюгат, концентрат, серия 4	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл (соответствует)
Раствор для разведения конъюгата (РК), серия 4	Жидкость синего цвета, 1 фл., 14,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 14,5 мл (соответствует)
Калибровочный образец 1 (K1), серия 4	Жидкость светло-зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость светло-зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Калибровочный образец 2 (K2), серия 4	Жидкость зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость зеленого цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 1 (KO1), серия 4	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 2 (KO2), серия 4	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0	Жидкость светло-желтого цвета, 1


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1 (1)
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1 (2)
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.

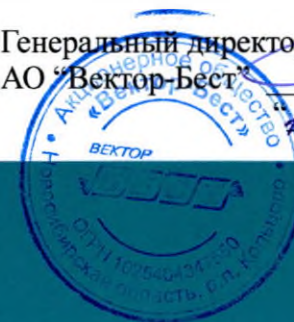

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 4
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 5
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 6
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 7
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
15.05.2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.

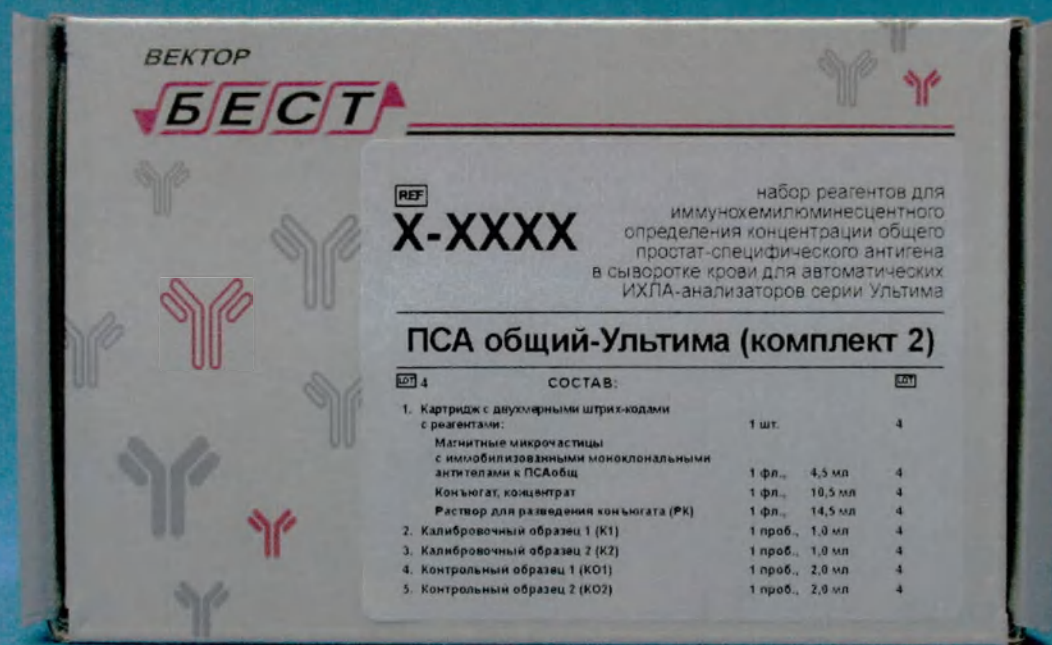

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2 (1)
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 2 (2)
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.






Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«16» 05 2023 г.

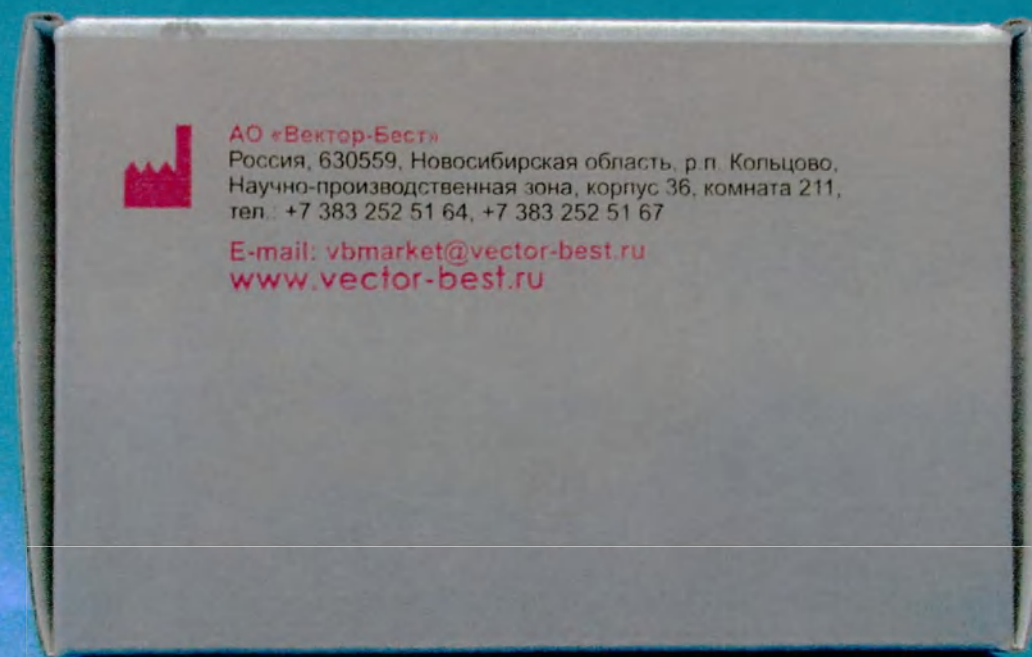

**Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного
 определения концентрации общего простат-специфического антигена
 в сыворотке крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима
 «ПСА общий-Ультима»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ПСА общий-Ультима» (комплект 1)

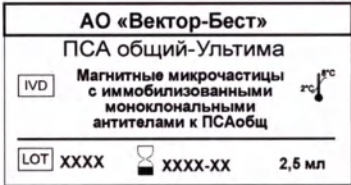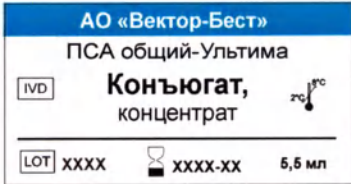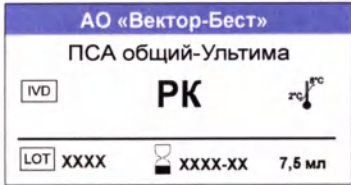Наименование компонента		Этикетка
Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами	Основная этикетка	
	Дополнительная этикетка	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ		
Конъюгат, концентрат		
Раствор для разведения конъюгата (РК)		

Наименование компонента	Этикетка
Калибровочный образец 1 (K1)	
Калибровочный образец 2 (K2)	
Контрольный образец 1 (KO1)	
Контрольный образец 2 (KO2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ПСА общий-Ультима» (комплект 1)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима	
ПСА общий-Ультима (комплект 1)				
LOT	XXXX	Состав:	LOT	XXXX
1. Картридж с двумерными штрих-кодами с реагентами: 1 шт. XXXX				
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ 1 фл., 2,5 мл XXXX				
Конъюгат, концентрат 1 фл., 5,5 мл XXXX				
Раствор для разведения конъюгата (РК) 1 фл., 7,5 мл XXXX				
2. Калибровочный образец 1 (K1) 1 проб., 1,0 мл XXXX				
3. Калибровочный образец 2 (K2) 1 проб., 1,0 мл XXXX				
4. Контрольный образец 1 (КО1) 1 проб., 2,0 мл XXXX				
5. Контрольный образец 2 (КО2) 1 проб., 2,0 мл XXXX				

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 100	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-211-23548172-2023 РУ				
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX				
ПСА общий-Ультима (комплект 1)				
IVD		2°C		
www.vector-best.ru				
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковые этикетки №№ 2, 3.

ПСА общий-Ультима			
Калибровочные образцы (K1 и K2)			
LOT	XXXX	XXXX-XX	IVD

ПСА общий-Ультима			
Контрольные образцы (КО1 и КО2)			
LOT	XXXX	XXXX-XX	IVD

2.4. Боковая этикетка № 4.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 4 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников

« 05 » март 2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масяго А.В. Масяго
«05» мая 2023 г.

[Handwritten signature]

**Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного
 определения концентрации общего простат-специфического антигена
 в сыворотке крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима
 «ПСА общий-Ультима»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ПСА общий-Ультима» (комплект 2)

Наименование компонента		Этикетка
Картридж с двумерными штрих-кодами с реагентами	Основная этикетка	
	Дополнительная этикетка	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ		
Конъюгат, концентрат		
Раствор для разведения конъюгата (РК)		

Наименование компонента	Этикетка
Калибровочный образец 1 (K1)	
Калибровочный образец 2 (K2)	
Контрольный образец 1 (KO1)	
Контрольный образец 2 (KO2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ПСА общий-Ультима» (комплект 2)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима	
ПСА общий-Ультима (комплект 2)				
LOT XXXX	Состав:		LOT XXXX	
1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами: 1 шт.				
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными				
моноклональными антителами к ПСАобщ				
Конъюгат, концентрат				
Раствор для разведения конъюгата (РК)				
2. Калибровочный образец 1 (K1)				
3. Калибровочный образец 2 (K2)				
4. Контрольный образец 1 (KO1)				
5. Контрольный образец 2 (KO2)				

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 200	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-211-23548172-2023 РУ				
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX				
ПСА общий-Ультима (комплект 2)				
IVD		2°C		
www.vector-best.ru				
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковые этикетки №№ 2, 3.

ПСА общий-Ультима Калибровочные образцы (K1 и K2)				
LOT	XXXX		XXXX-XX	2°C
IVD				

ПСА общий-Ультима Контрольные образцы (KO1 и KO2)				
LOT	XXXX		XXXX-XX	2°C
IVD				

2.4. Боковая этикетка № 4.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 4 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников

«05»

2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго
"05" мая 2023 г.