

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения Тропонина I (Troponin I), миоглобина (Myoglobin), изофермента креатинкиназы МВ (СК-МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay Troponin I/Myoglobin/СК-МВ (3 in 1) Test Kit), в вариантах исполнения»



Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I



Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II

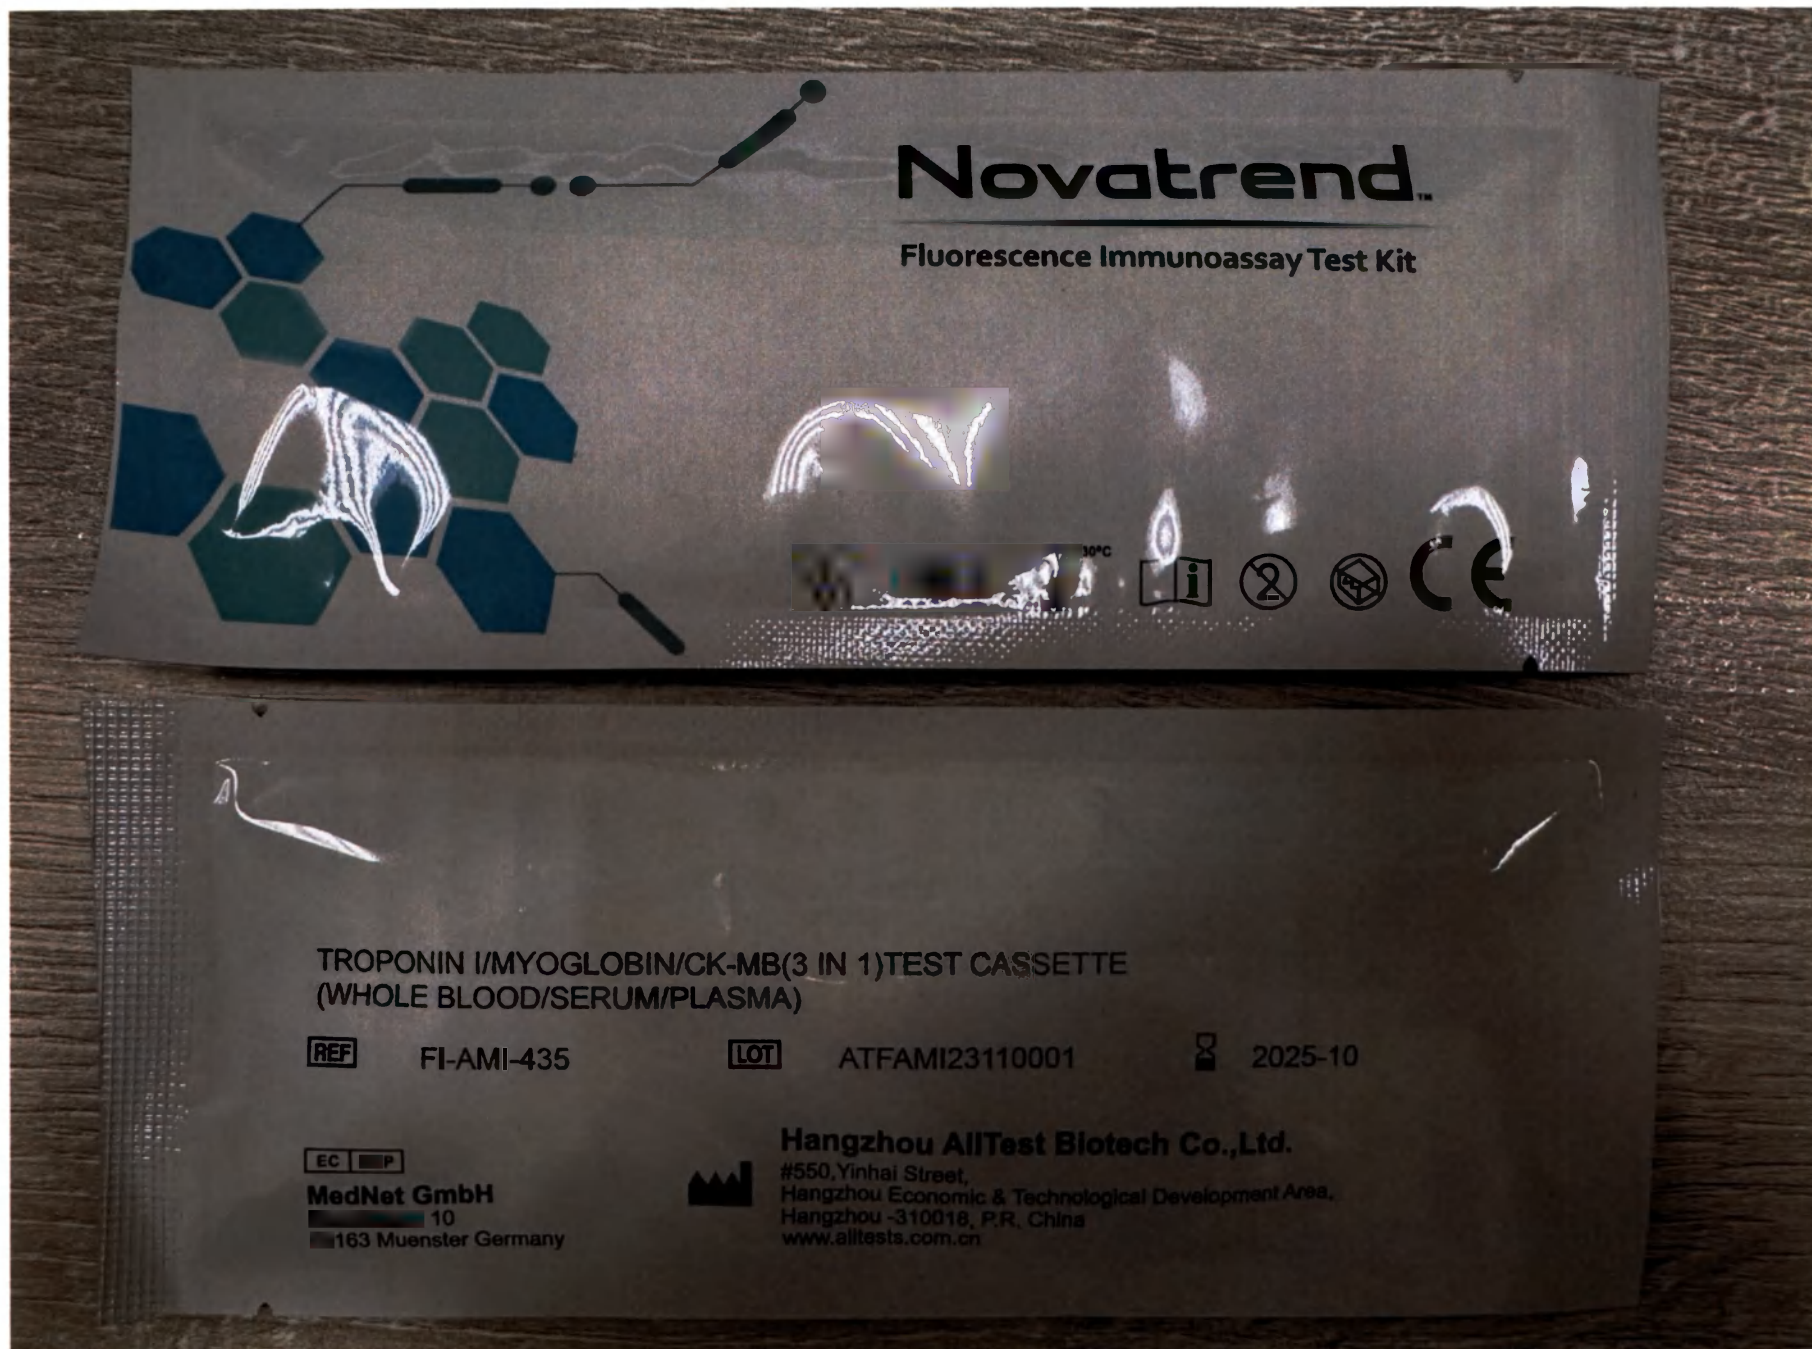


Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I



Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (Тропонин I/Миоглобин/СК-МВ (3 in 1) Test Cassette)



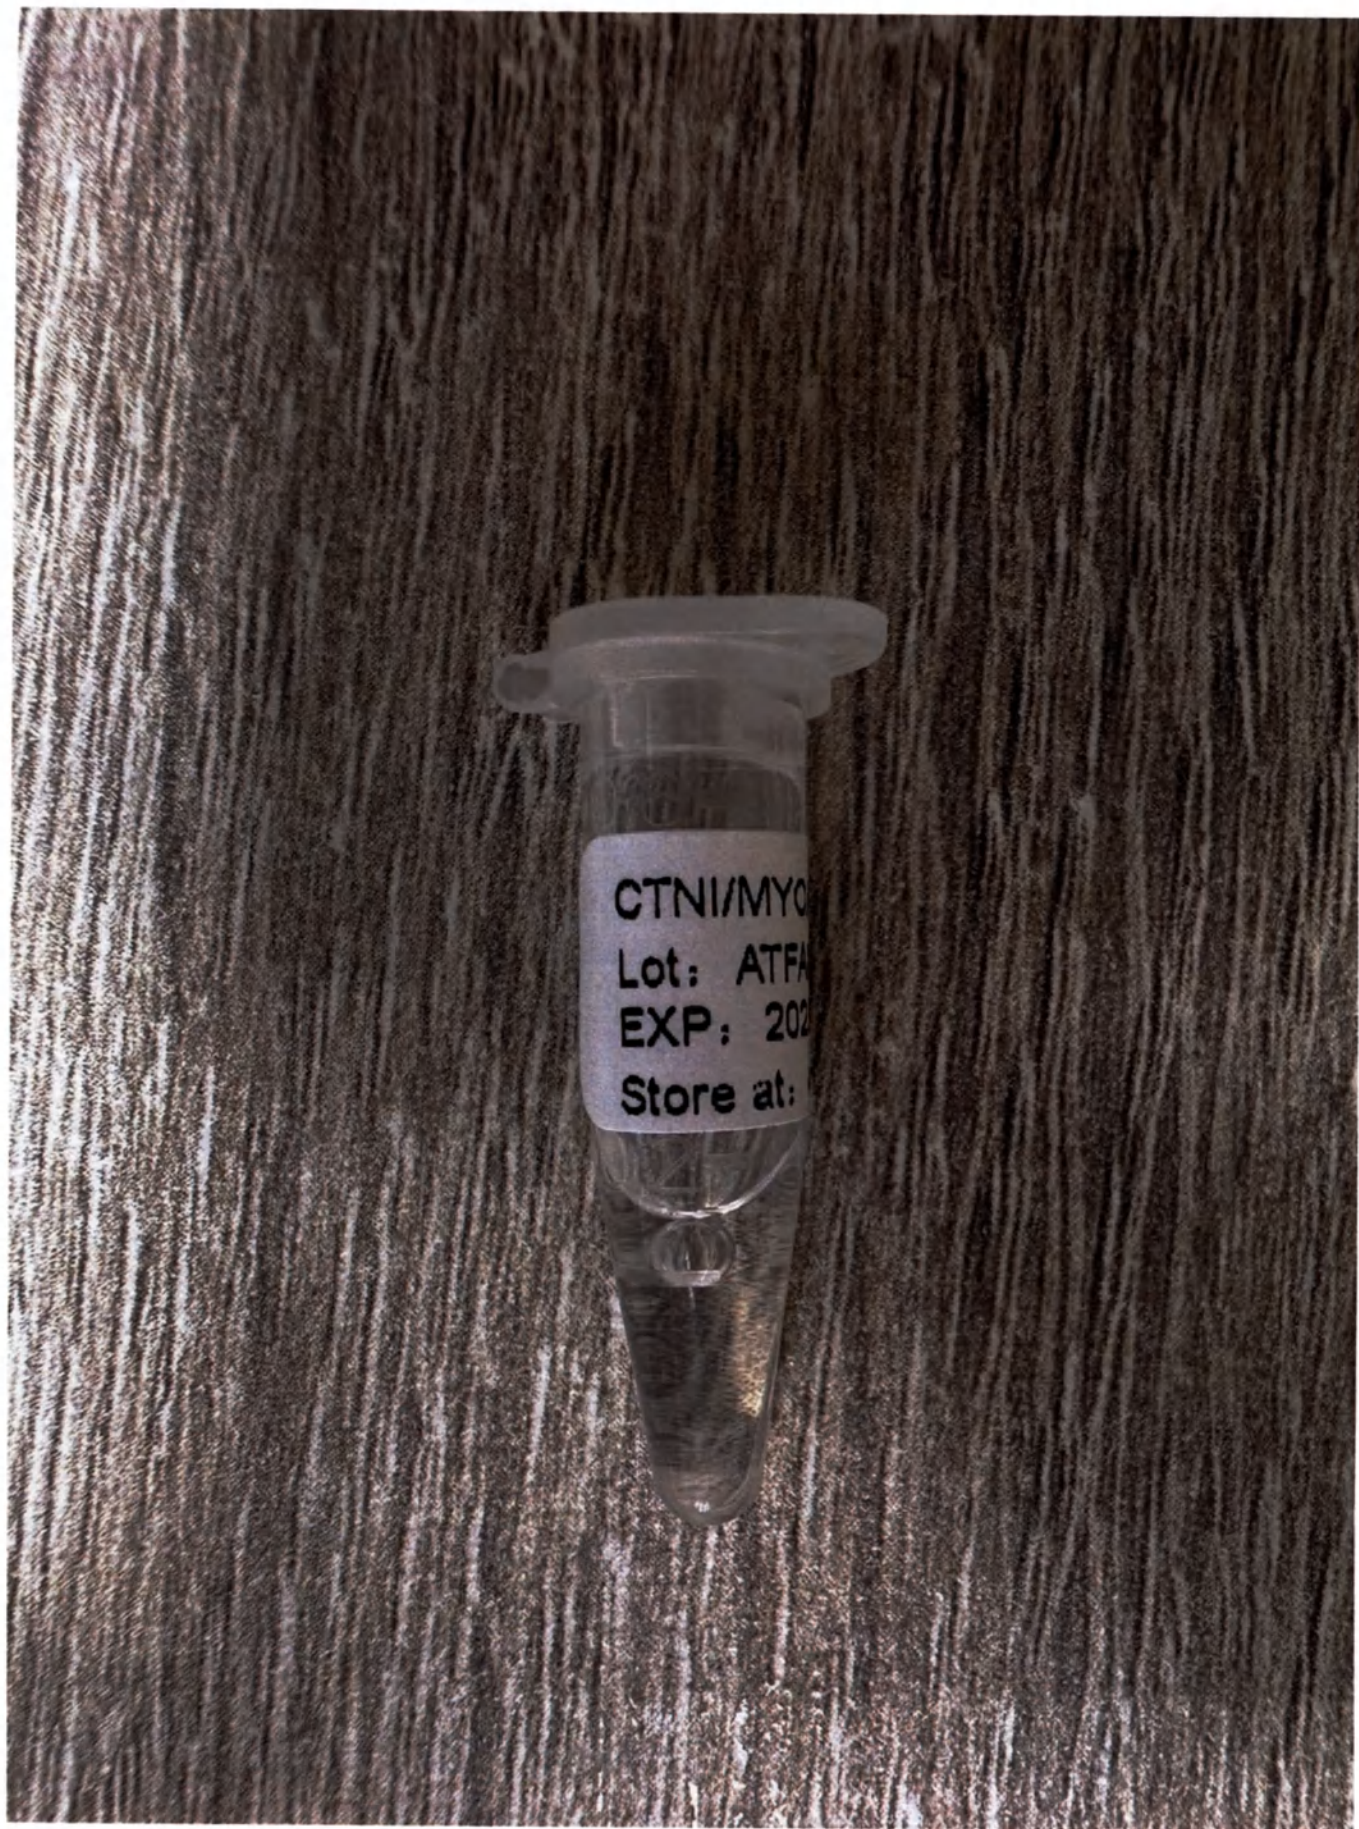


Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов

Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)





Рисунок 9. Идентификационная карта



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ**

«Набор реагентов для быстрого количественного определения Тропонина I (Troponin I),
миоглобина (Myoglobin), изофермента креатинкиназы MB (CK-MB)
иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе
Novatrend™ (Novatrend™ Fluorescence Immunoassay Troponin I/Myoglobin/CK-MB (3 IN 1)
Test Kit), в вариантах исполнения»

Производитель

«Ханчжоу Олтест Биотек Ко., Лтд.» (Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.), КНР
Адрес: 550#, Yinhai Street, Hangzhou Economic and Technological Development Area, 310018
Hangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Версия: 1.0

Дата последней редакции: январь 2024

Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие

ГЕН. ДИРЕКТОР
А.В. ЕЩОЛОВА Д.В.

ПРОШЕТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
12 ЛИСТОВ