

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (D-Dimer) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови или плазме на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay D-Dimer Test Kit), в вариантах исполнения»

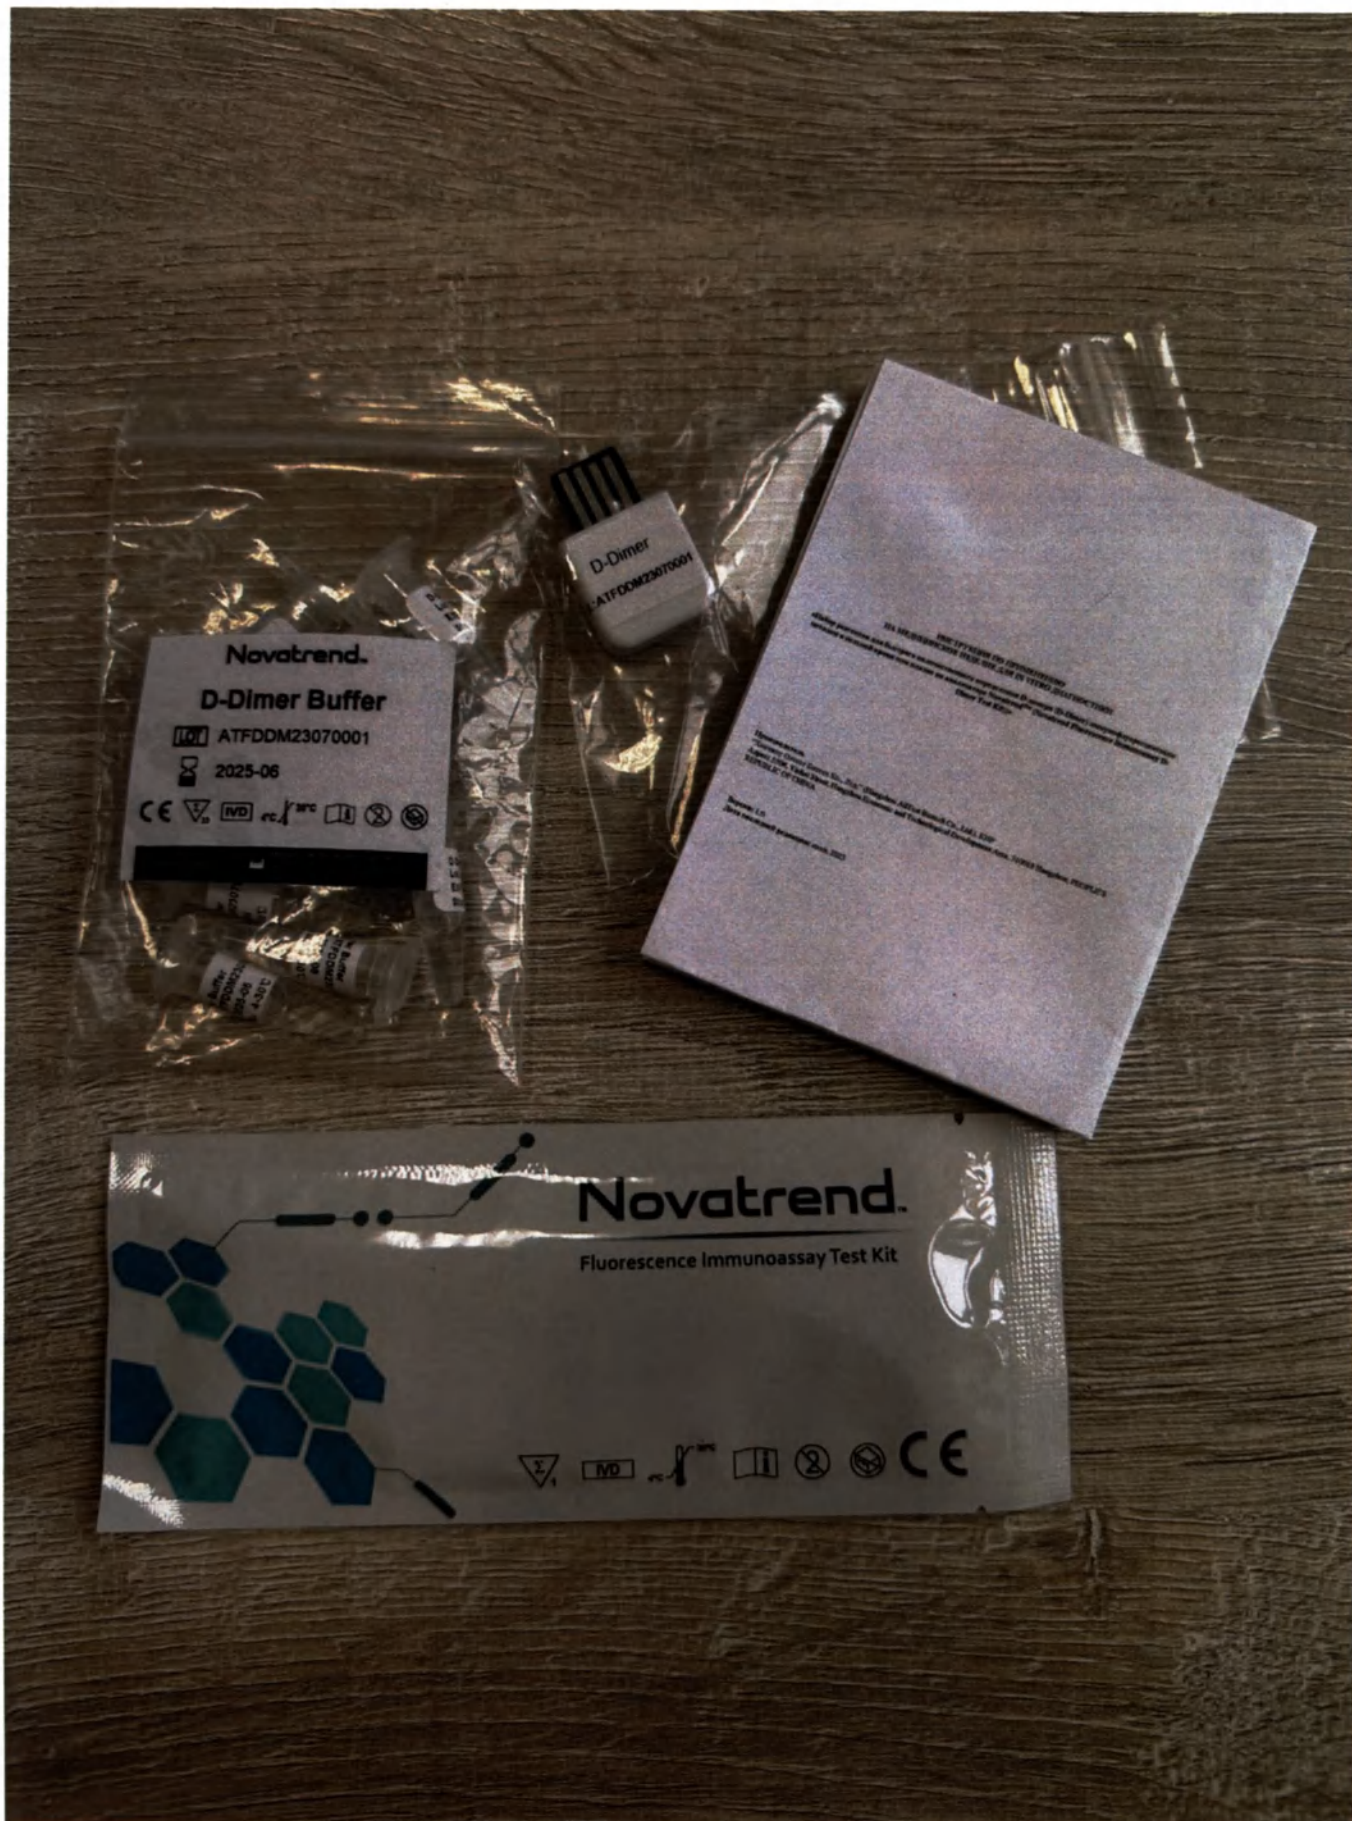


Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I

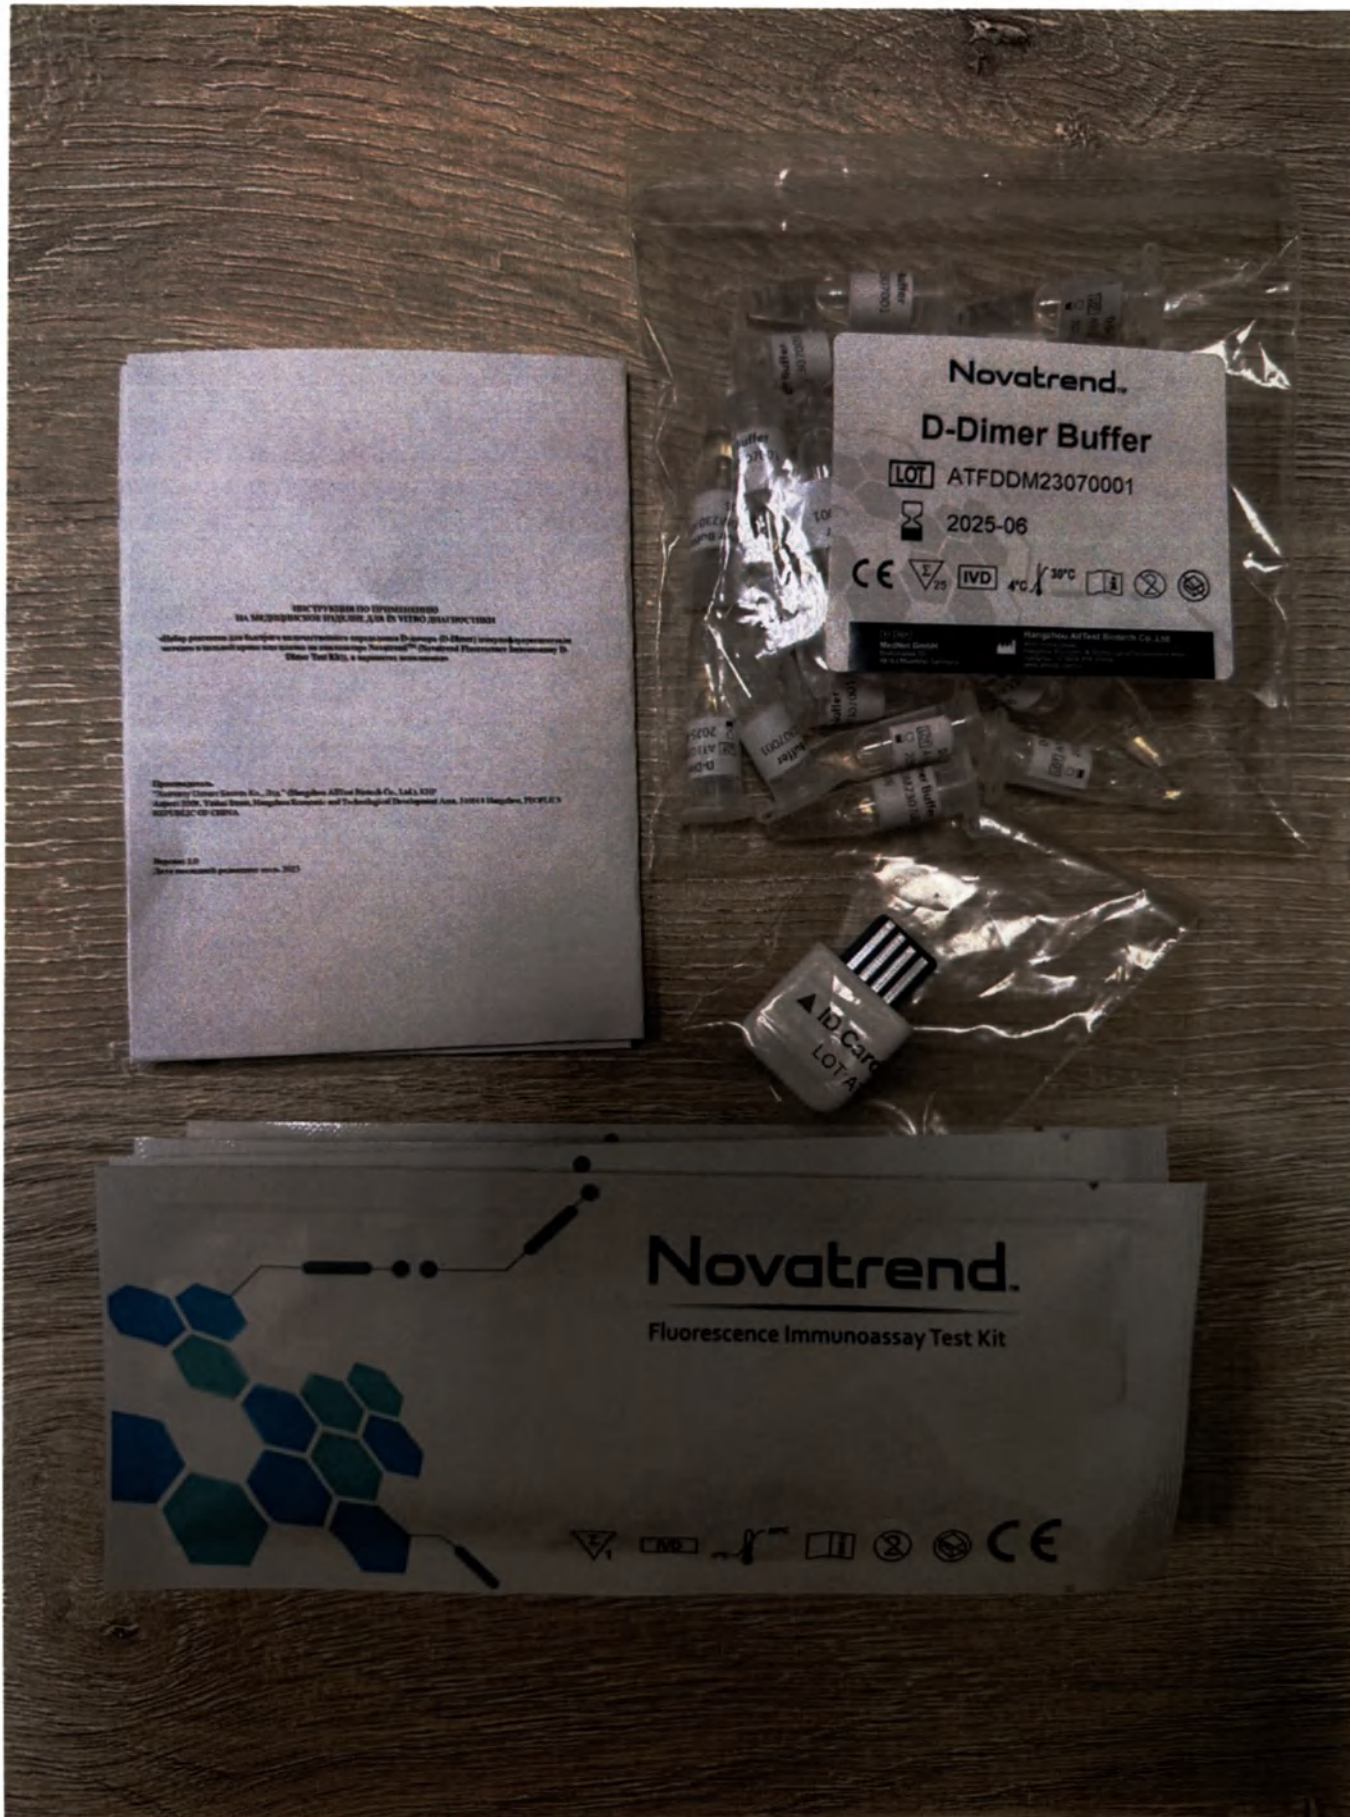


Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II

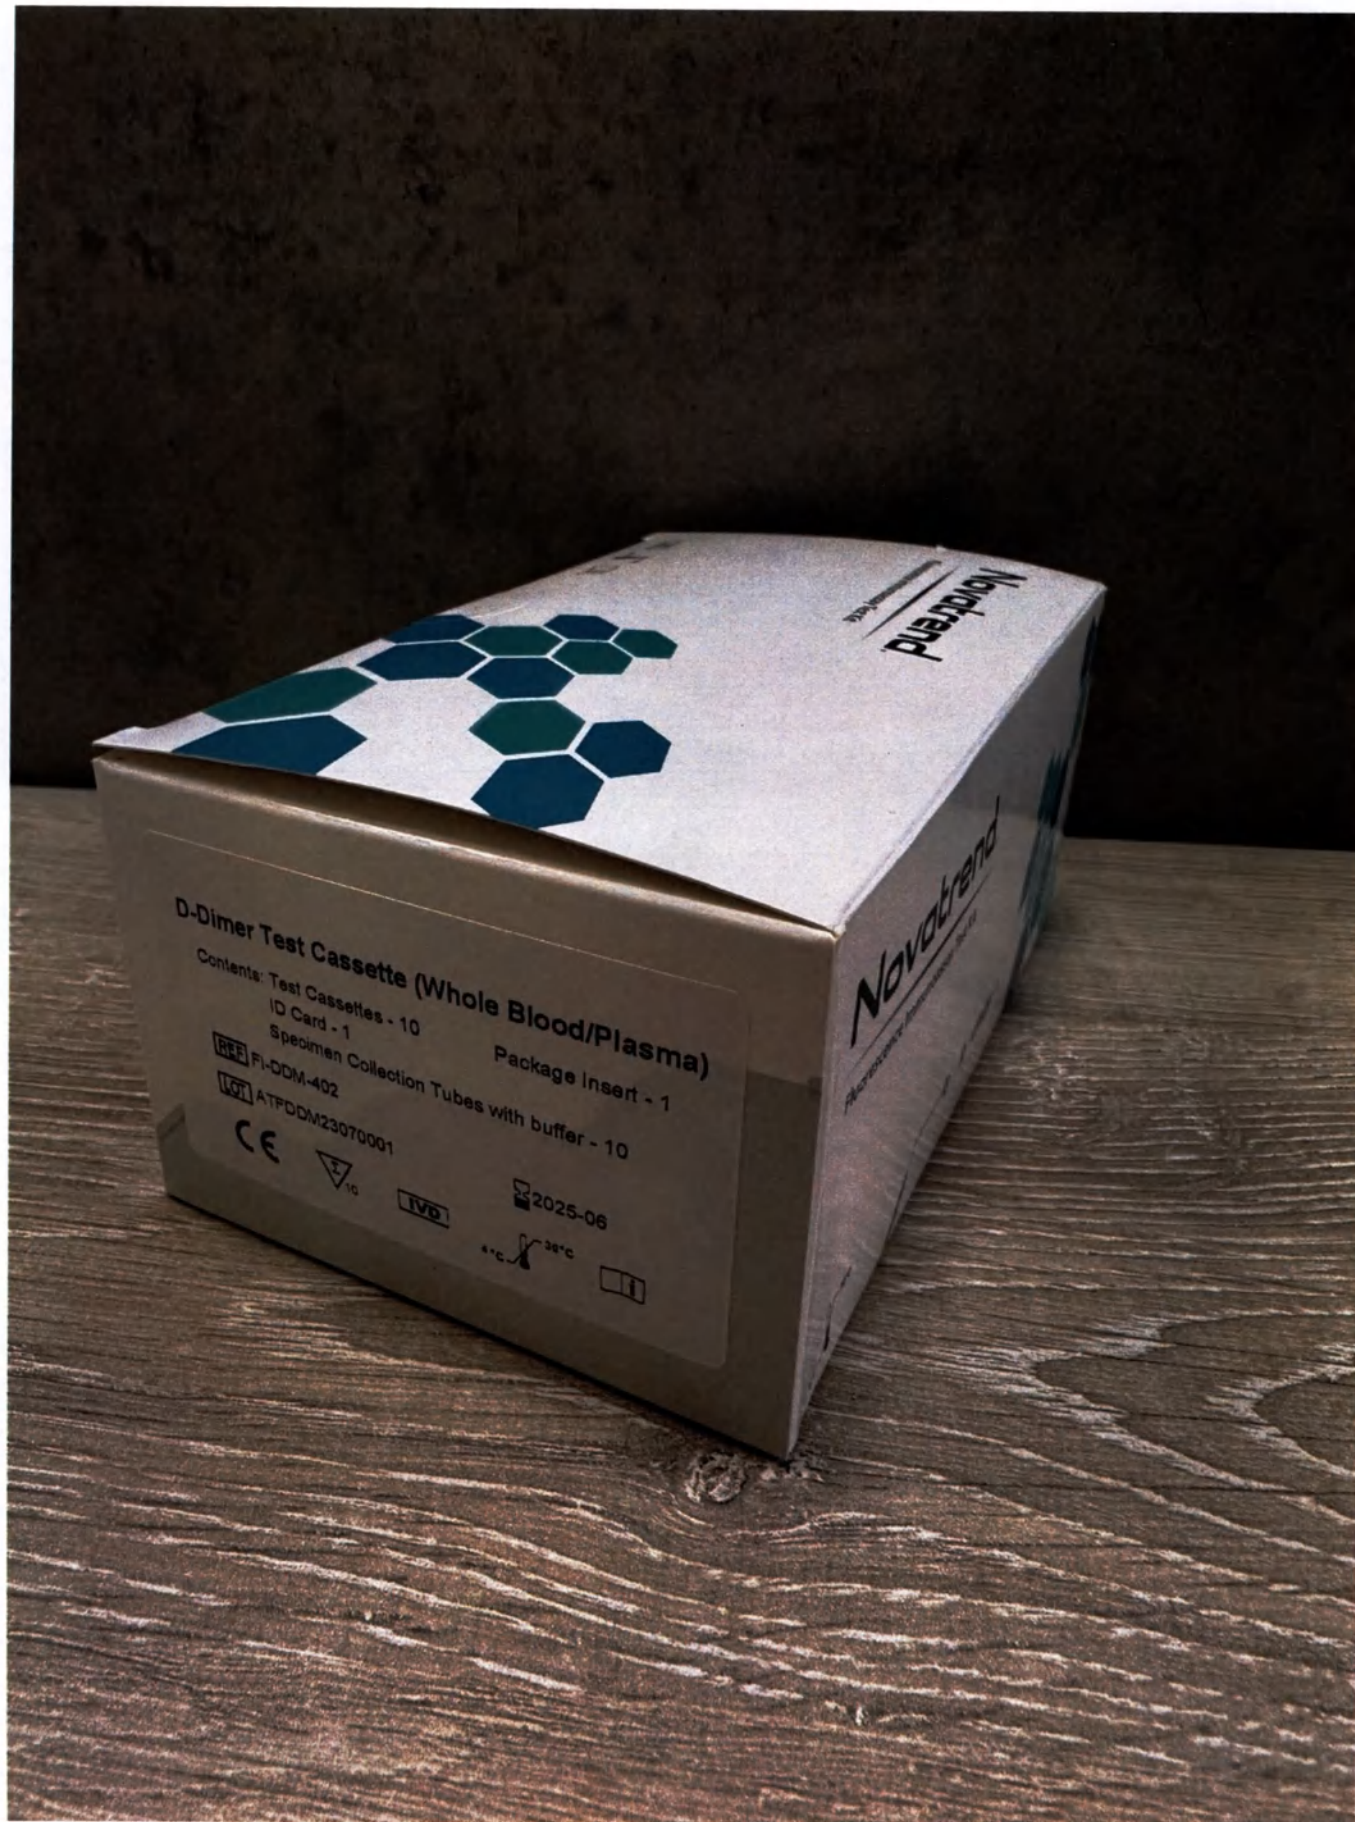


Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I

Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II





Рисунок 5. Первичная упаковка тест-кассеты (D-Dimer Test Cassette), тест-кассета (D-Dimer Test Cassette), осушитель

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (D-Dimer Test Cassette)





Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов



Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)



Рисунок 9. Идентификационная карта



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет)



Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАВАНО
12 ЛИСТОВ

