

Согласовано

ООО «Олимпас Москва»

Организация

107023, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27,

стр. 8

Адрес

Руководитель Отдела нормативно-правового
регулирования и регистрации медицинских изделий

Департамента медицинских систем

Должность

Данилова А.В.

Фамилия, Имя

15.06.2022

Дата ДД.ММ.ГГГГ



Подпись/Signature

Фотографические изображения Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH в составе

2022



Рис. 1. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на транспортной упаковке.

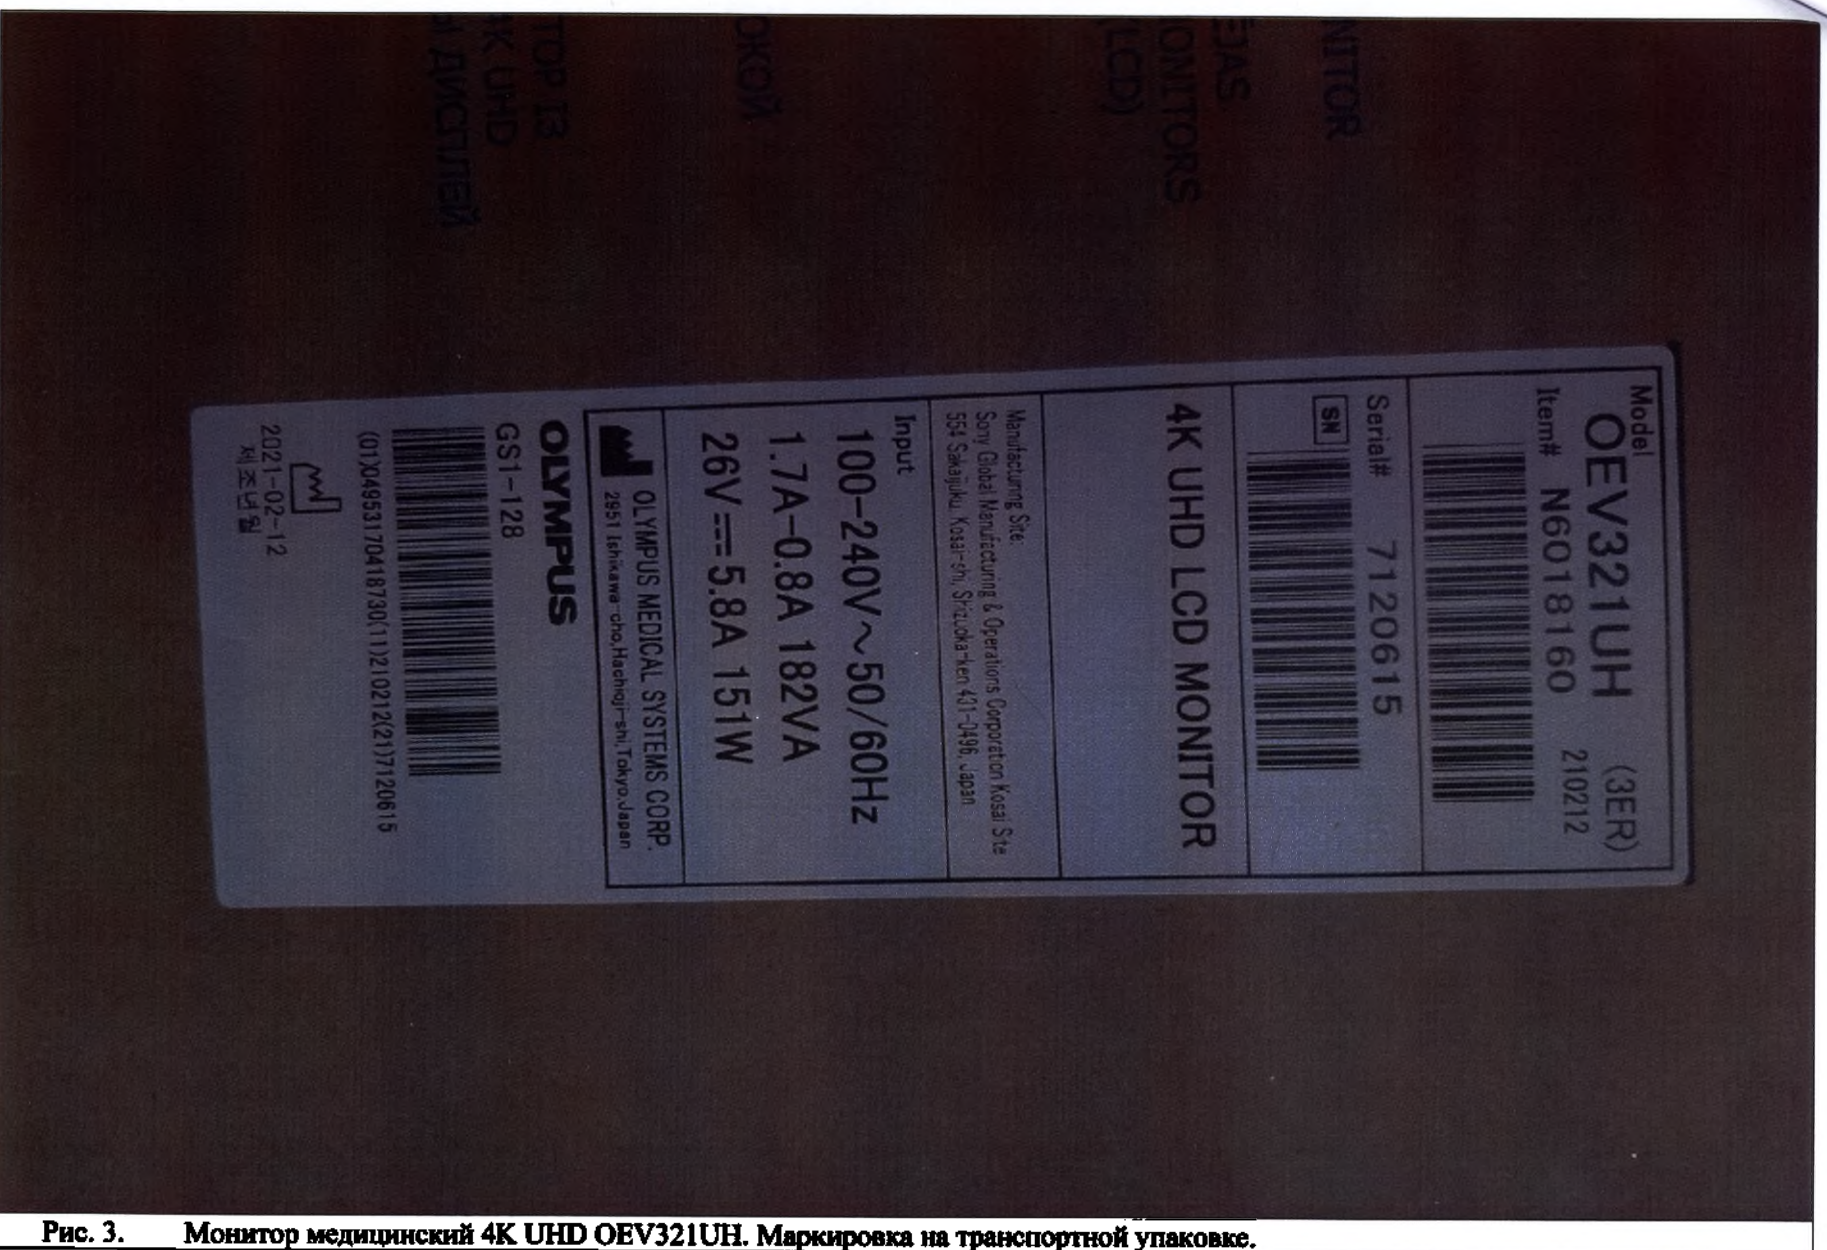


Рис. 3. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на транспортной упаковке.

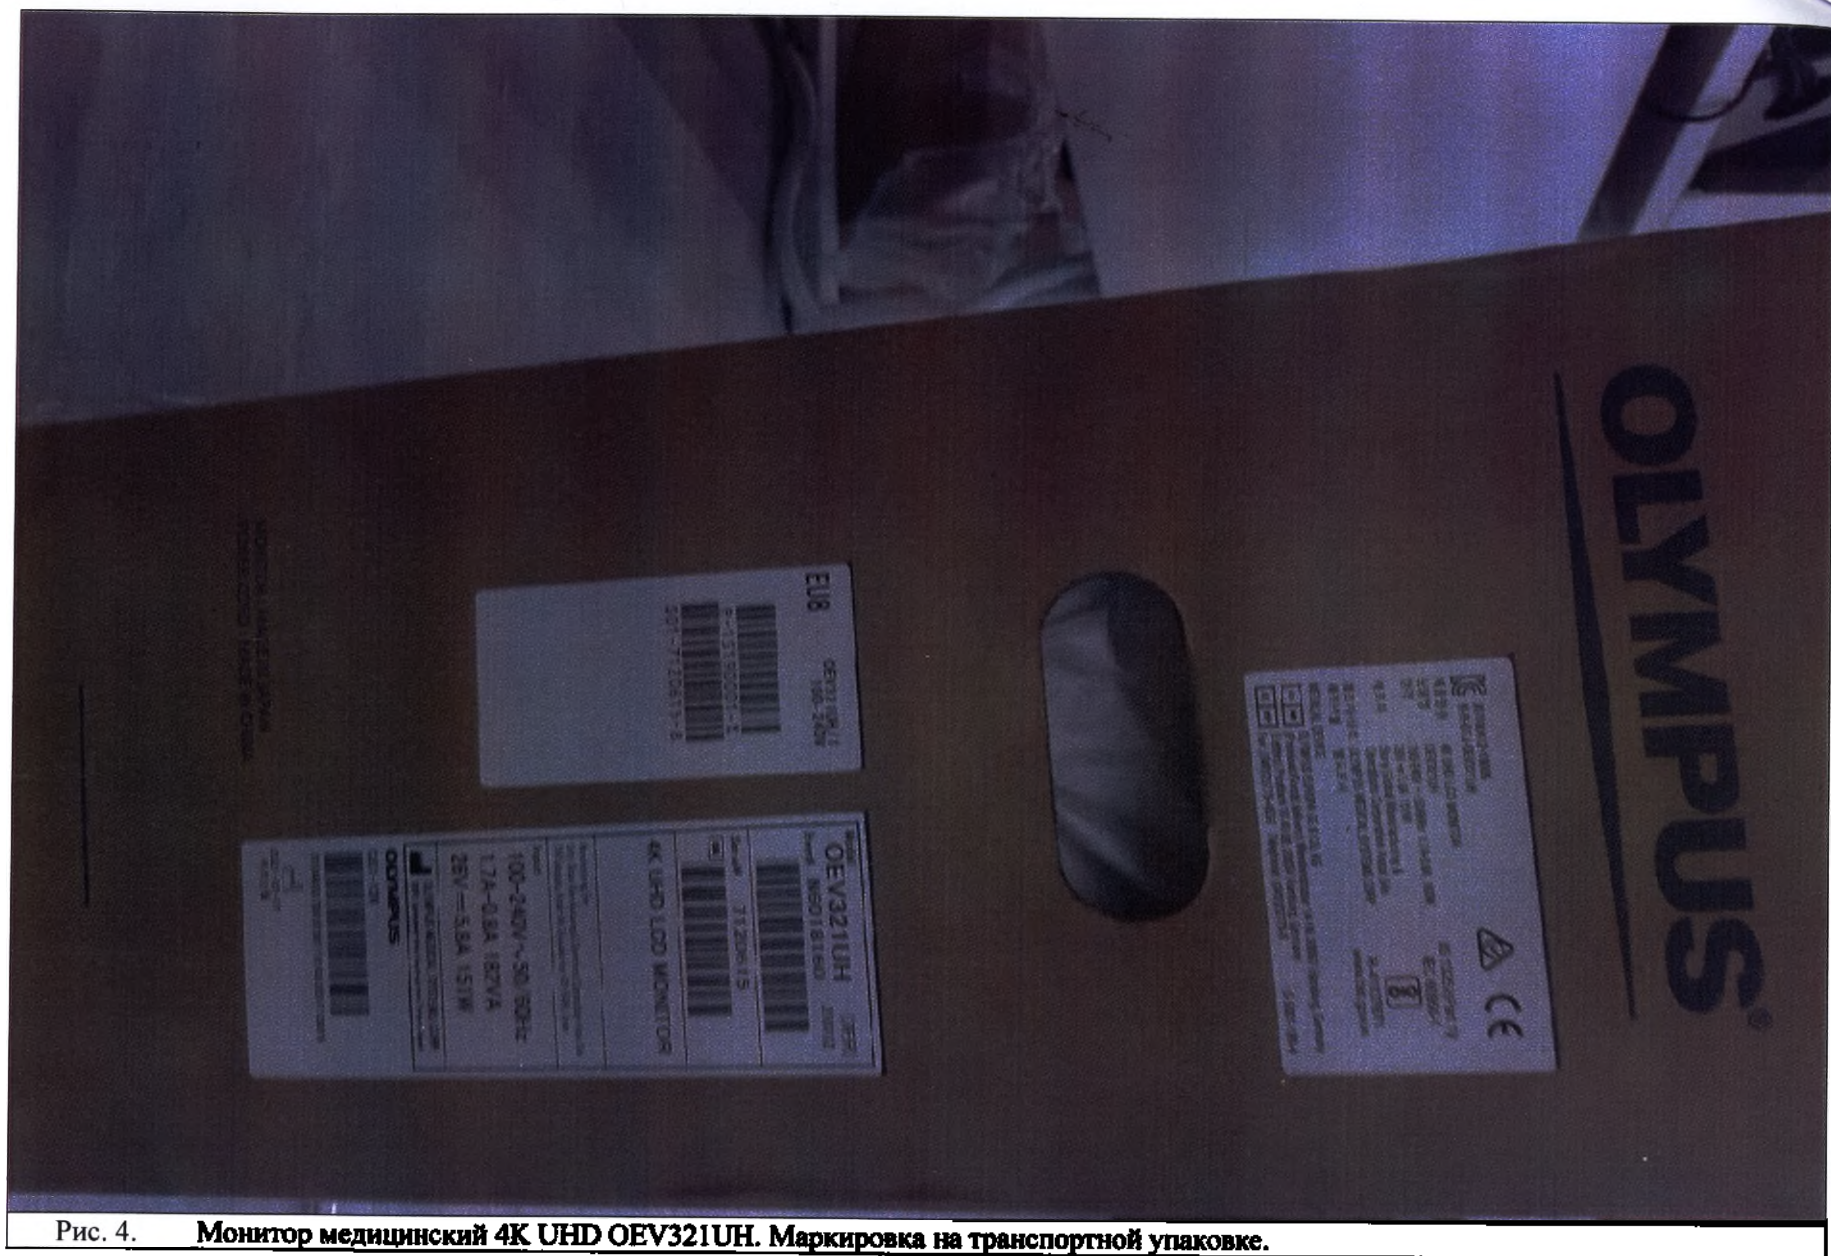


Рис. 4. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на транспортной упаковке.

4K UHD LCD MONITOR
4K UHD LCDモニター
高清晰度液晶監視器
OEV321UH

Производитель:
Olympus Medical Systems Corp.
(Олимпас Медикал Системс Корп.),
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi,
Tokyo 192-8507, Japan.

EAD

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Олимпас
Москва» (ООО «Олимпас Москва»), 107023, город Москва,
улица Электрозаводская, 27, стр. 8.
Тел.: +7 (495) 926-70-77

Дата изготовления: см. оригинальную упаковку
Серийный номер: см. оригинальную упаковку
Номер по каталогу: см. оригинальную упаковку

Стандартные условия хранения (например, в больших)	Температура окружающей среды от 5 °C до 40 °C Относительная влажность от 10 % до 90 % Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа
Условия хранения и транспортировки	Температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C Относительная влажность от 10 % до 90 % Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа

	напряжение, В	сила тока, А	Частота, Гц
переменного	100-240	1,7-0,8	50/60
постоянного	26	5,8	

Устройство должно быть подключено к заземлённой розетке

Рис. 5. Пример маркировки на русском языке на транспортной упаковке. Место нанесения маркировки и вид (шрифт, размер и пр.) могут отличаться от предоставленного.

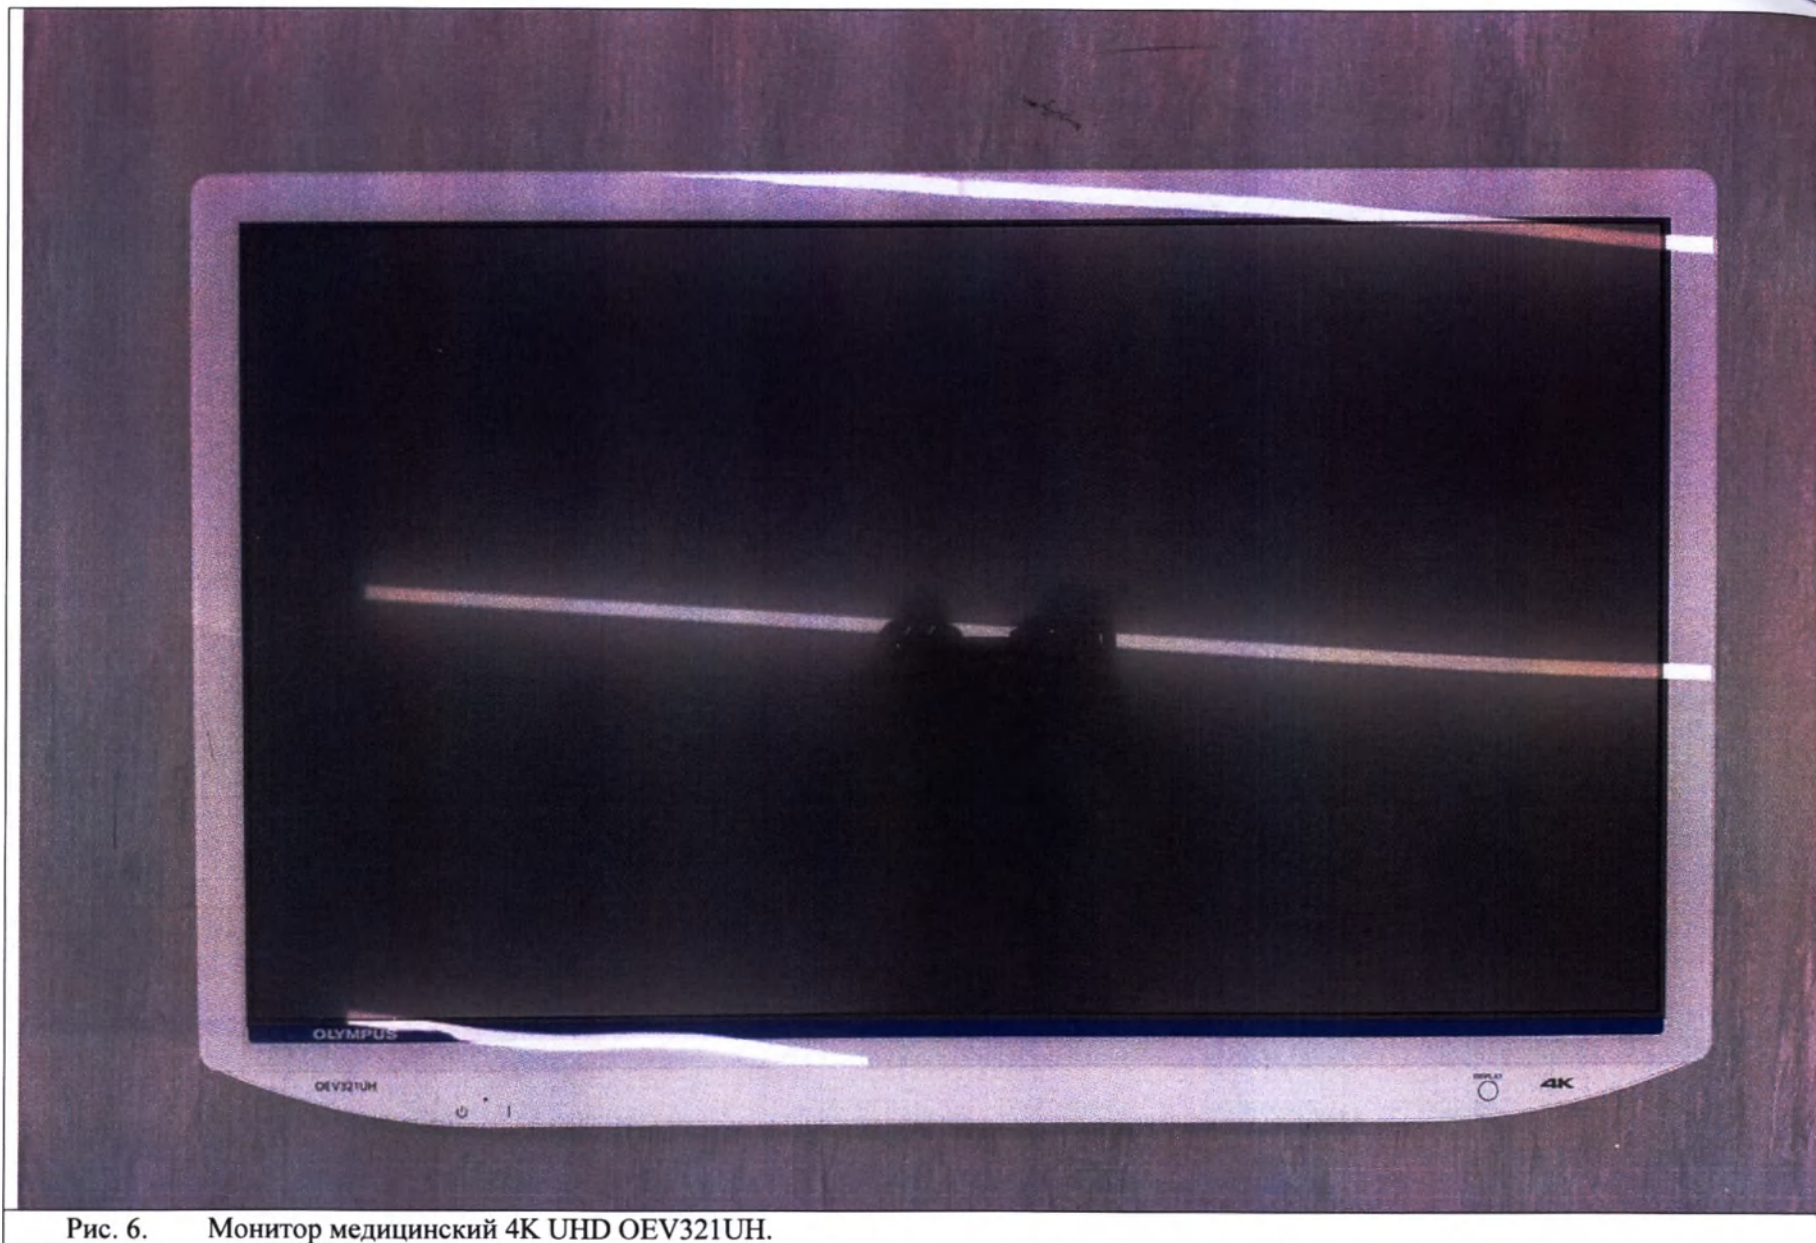


Рис. 6. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH.

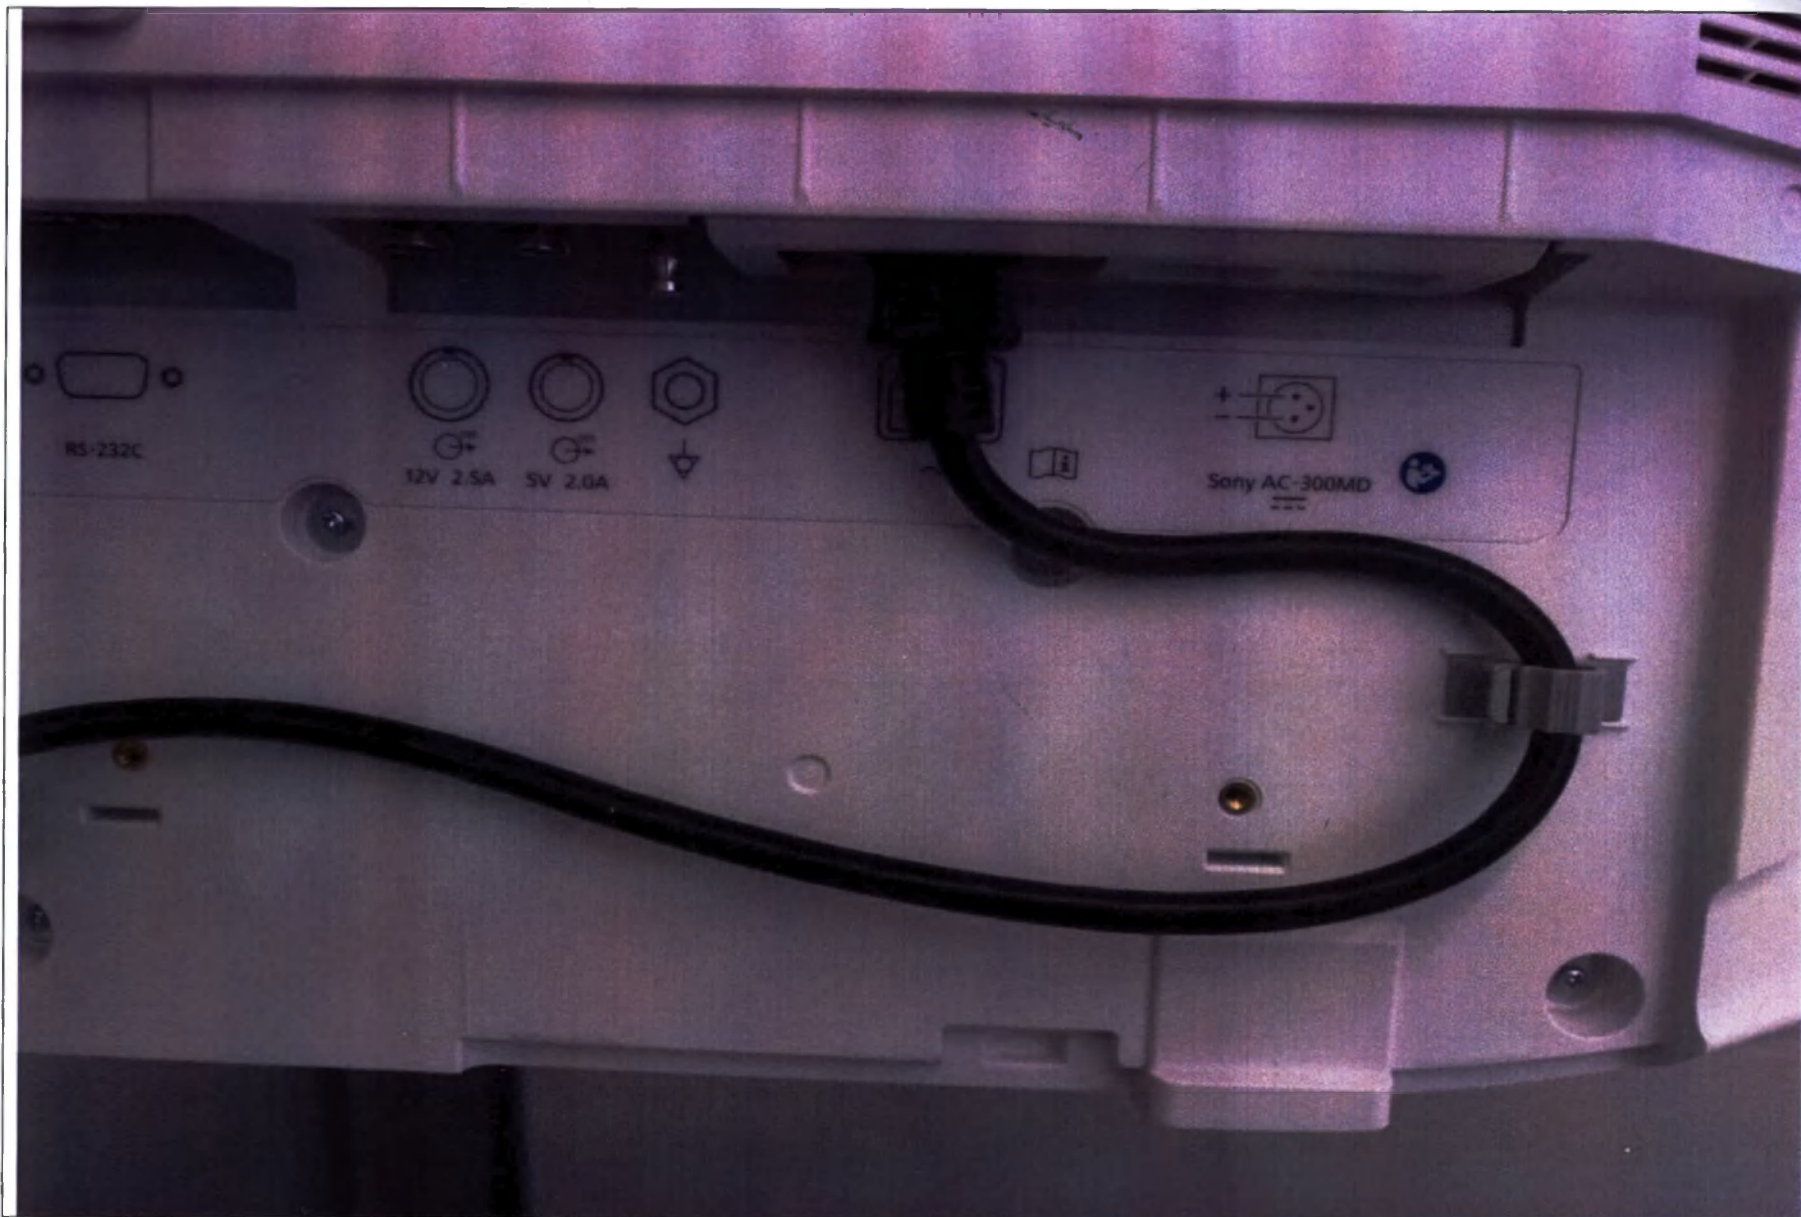


Рис. 7. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка задней панели.

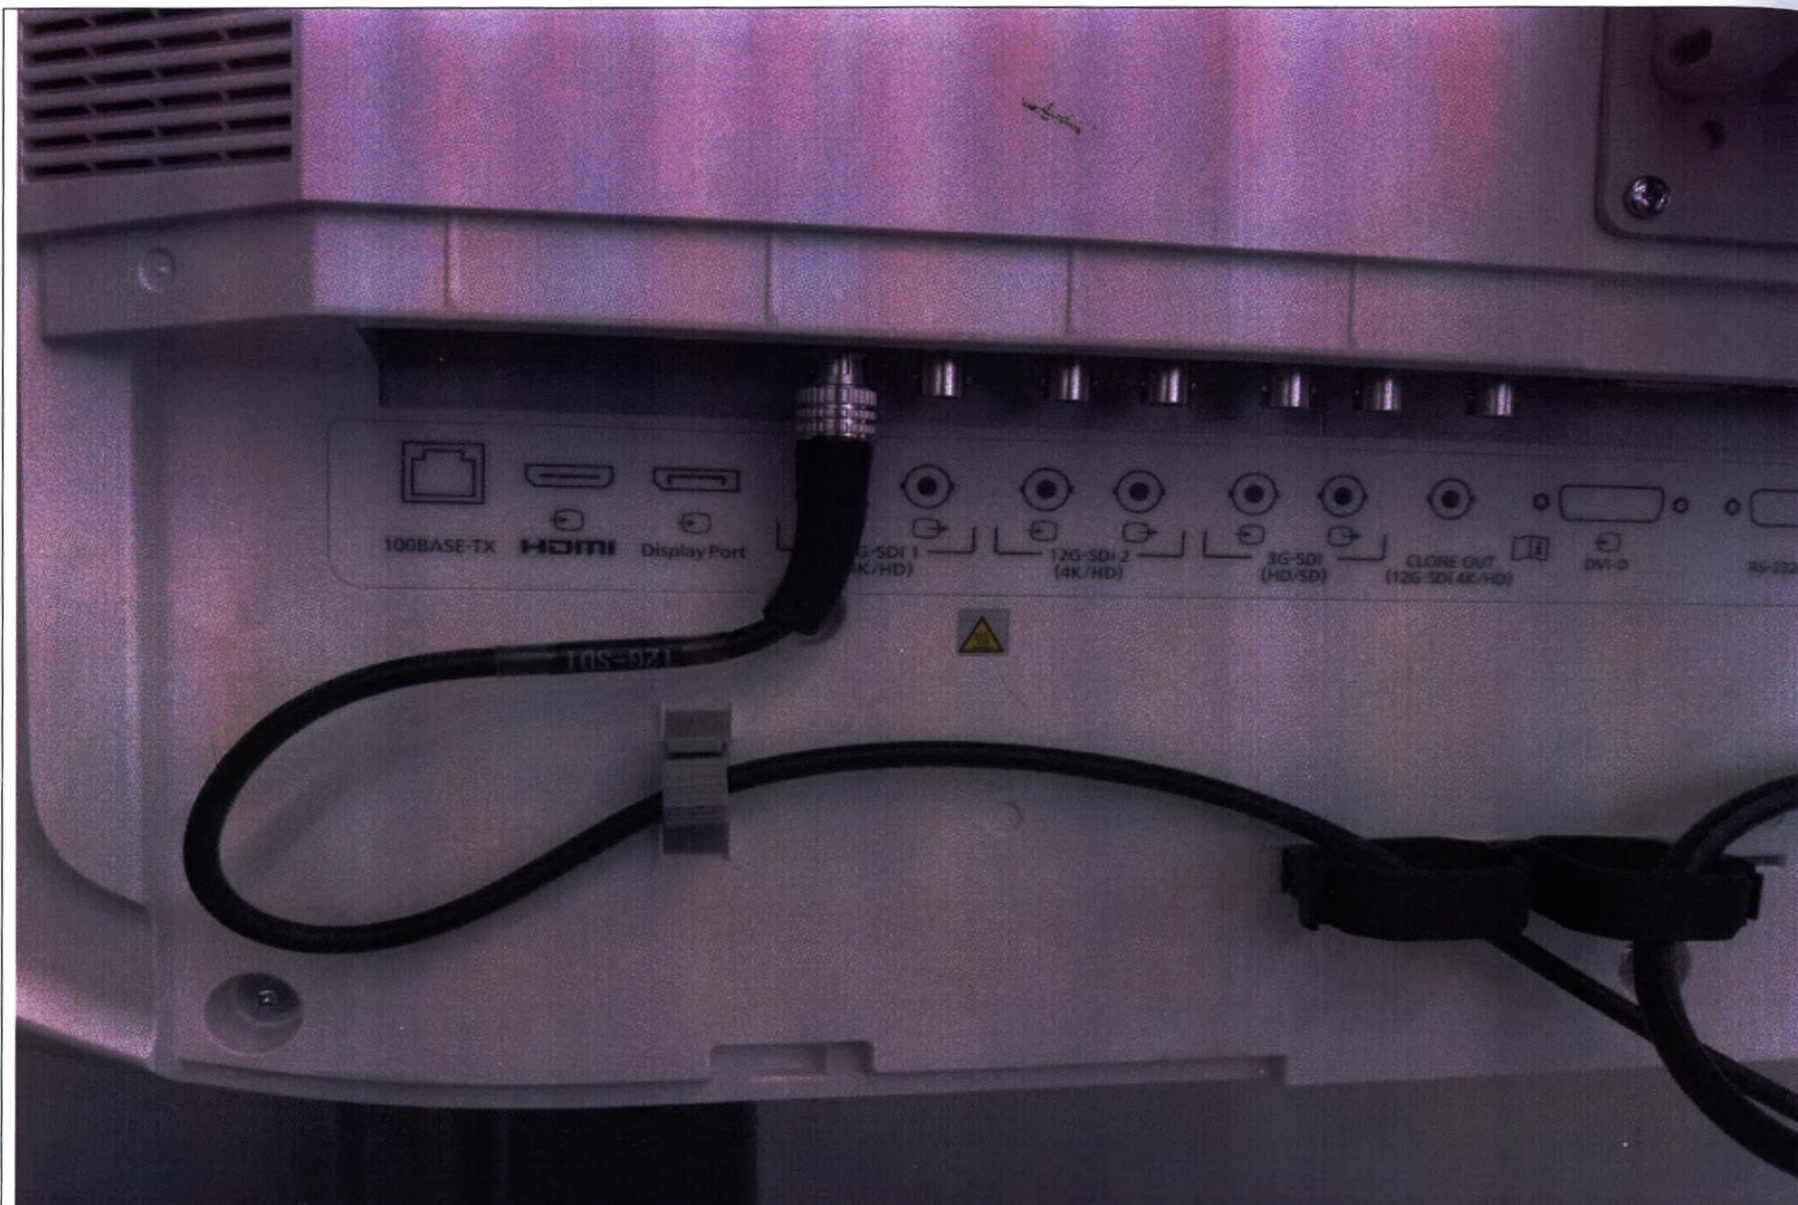


Рис. 8. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка задней панели.



Рис. 9. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Разъёмы задней панели.

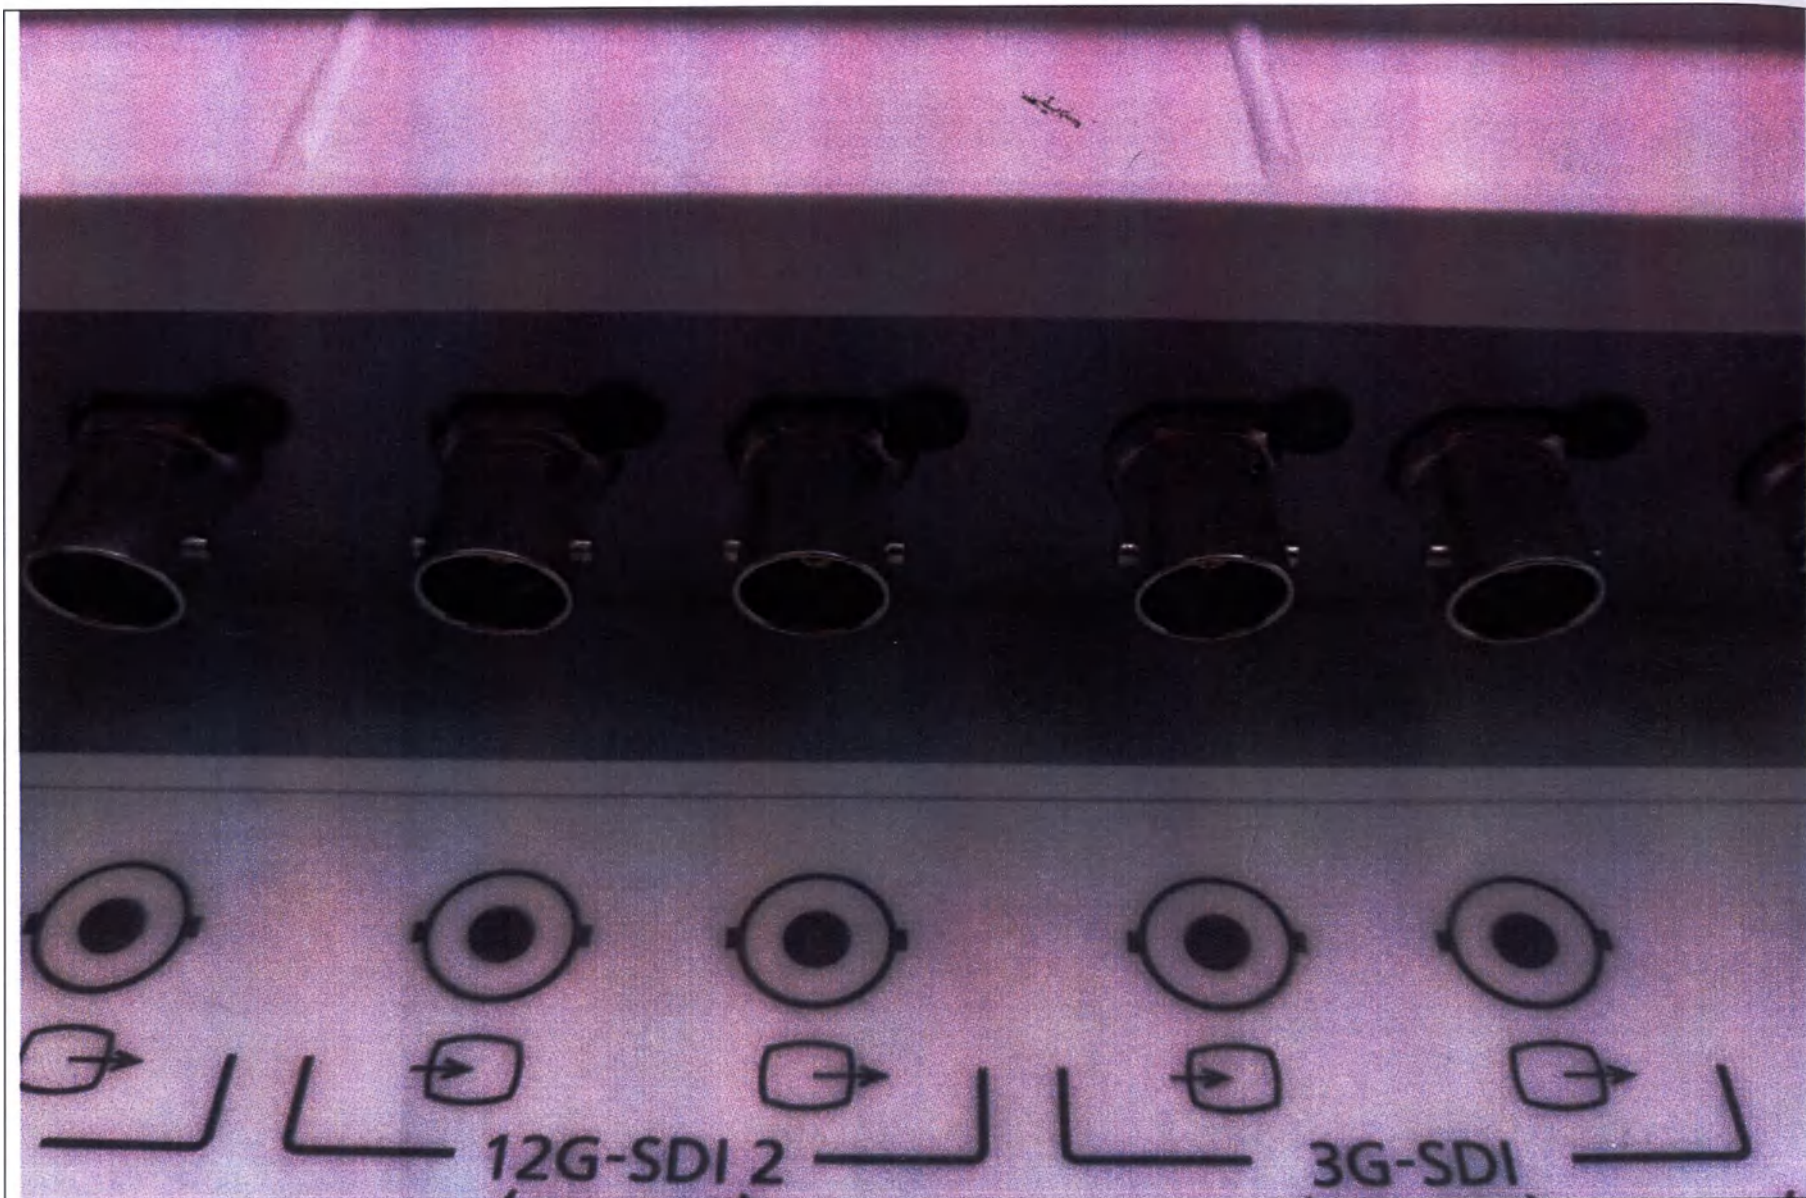


Рис. 10. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Разъёмы задней панели.



Рис. 11. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Разъёмы задней панели.

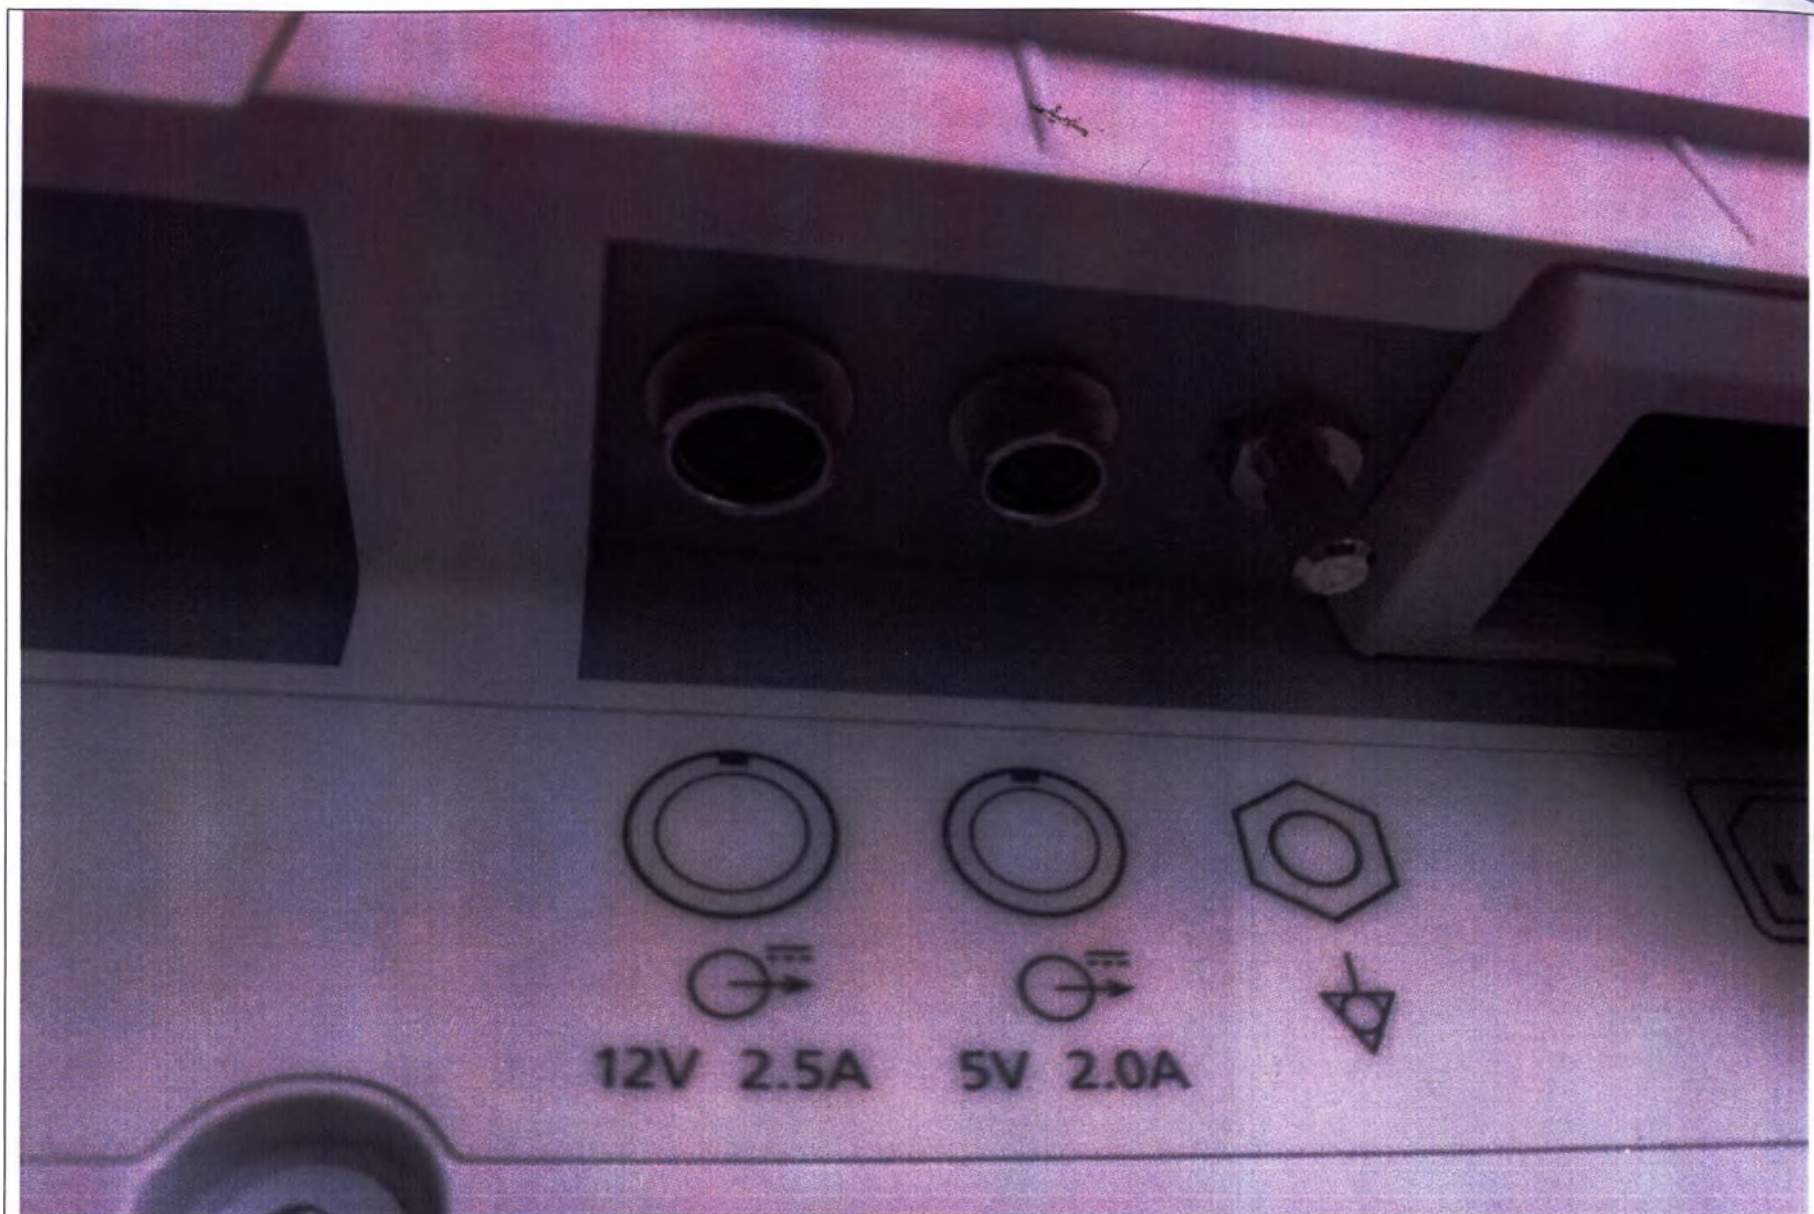


Рис. 12. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Разъёмы задней панели.

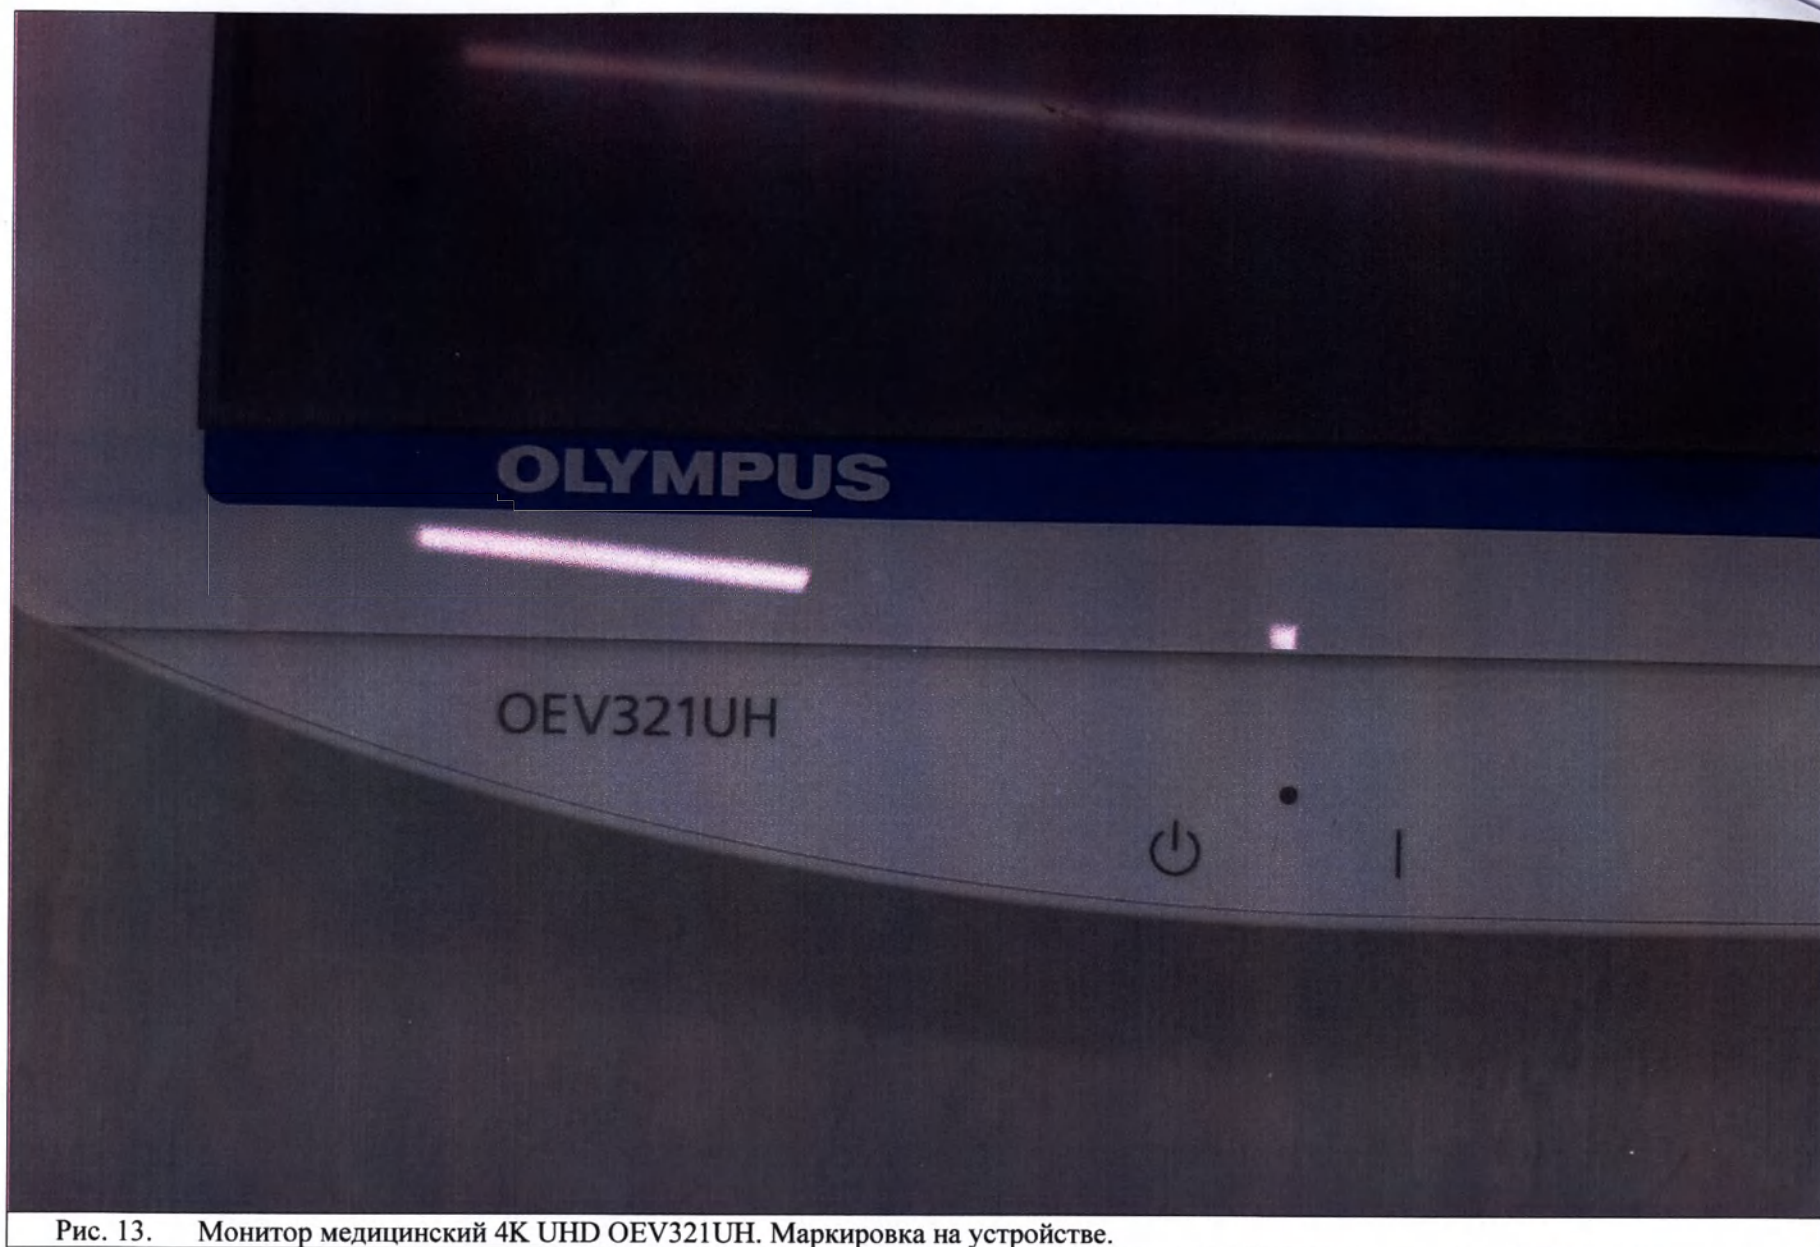


Рис. 13. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на устройстве.

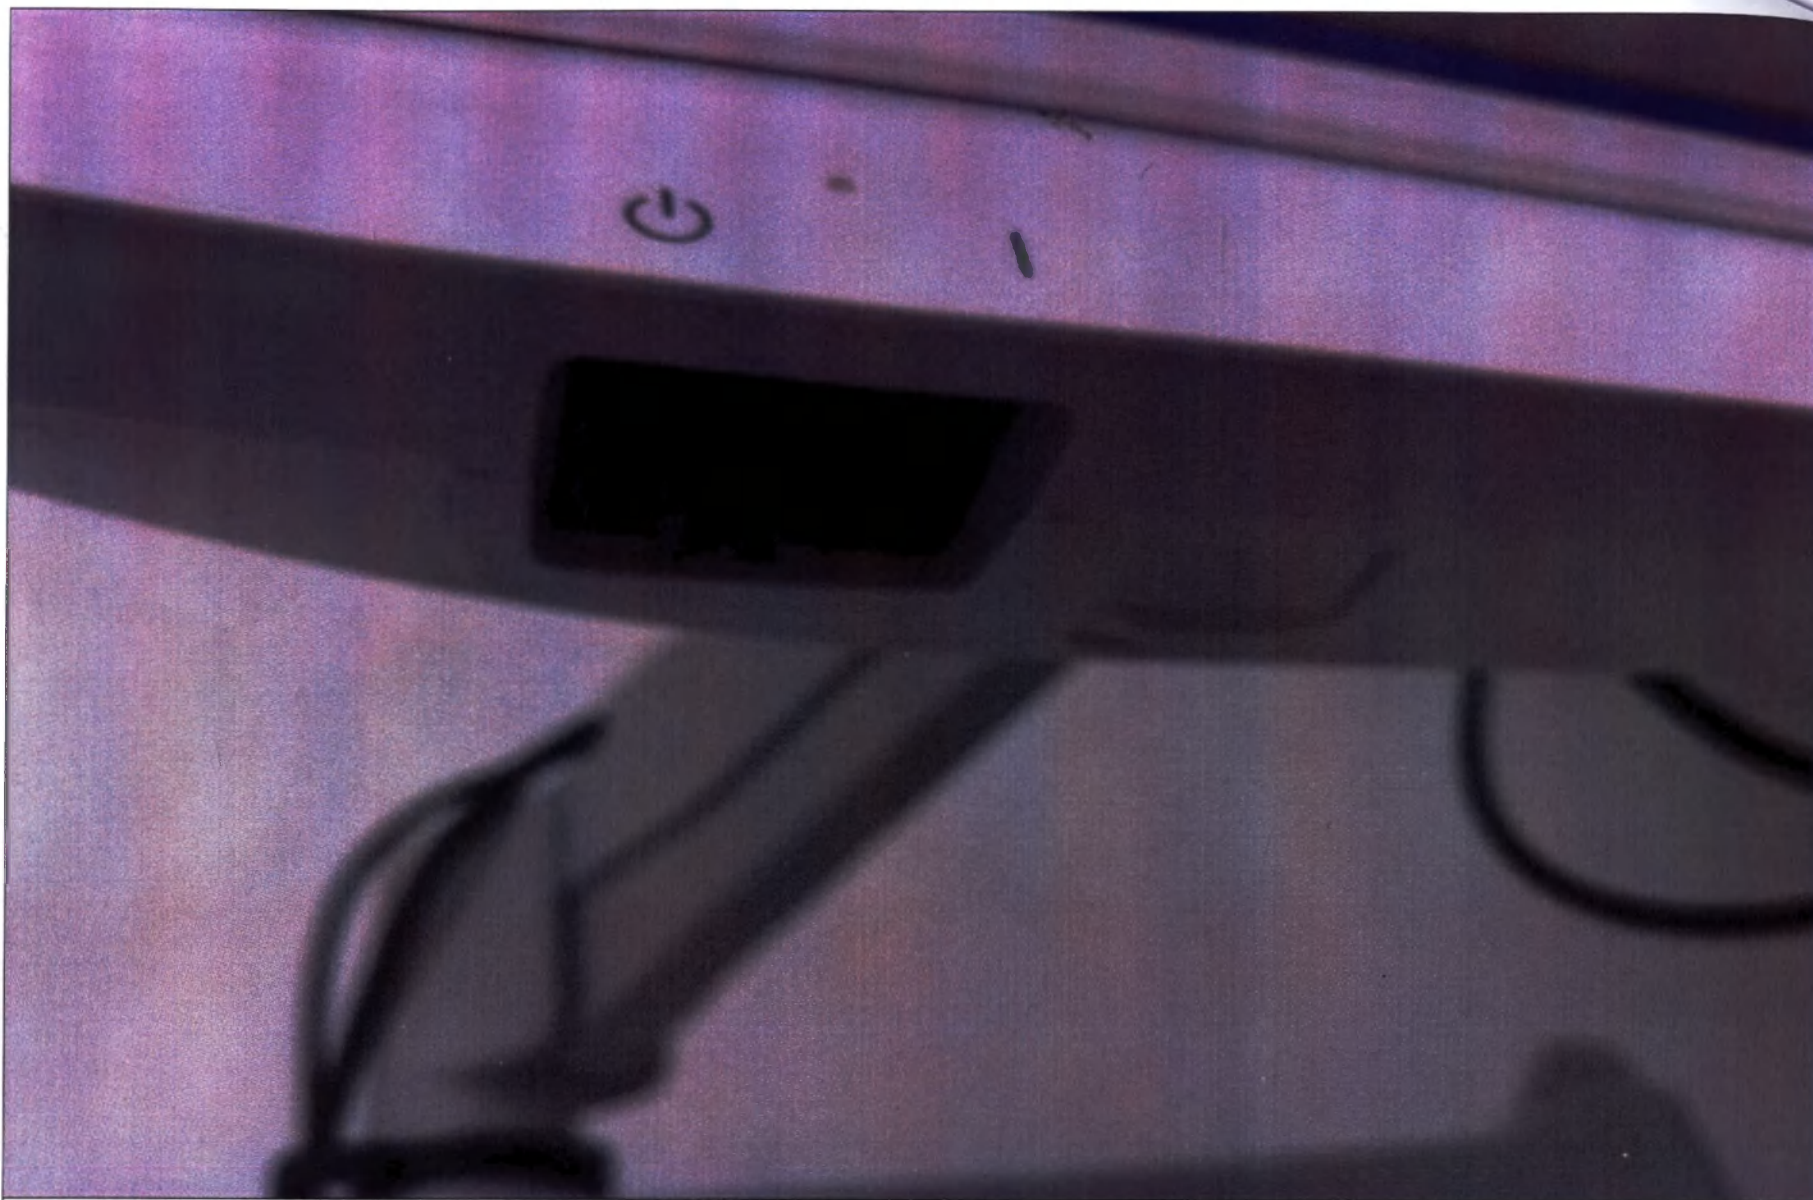


Рис. 14. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Переключатель вкл./режим ожидания.



Рис. 15. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на устройстве.

OLYMPUS

4K UHD LCD MONITOR

MODEL: OEV321UH

100-240V ~ 50/60Hz 1.7-0.8A 182VA

26V = 5.8A 151W

For use with power supply AC-300MD




XU100412-19005
R-R-0TJ-OEV321UH

MEDICAL DEVICE

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Laita on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord.
som giver forbindelse til stikproppens jord.

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8507 JAPAN



OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20087 Hamburg, Germany
(Letters) Postfach 10 49 00, 20034 Hamburg, Germany
Fax: (040)23773-4655 Telephone: (040)23773-0

SN 7120615



2021-02-12



(01)04953170418730
(11)210212(21)7120615

제품명 : 4K UHD LCD MONITOR
모델명 : OEV321UH
용량 : 100-240V ~ 50/60Hz 1.7-0.8A 183W
26V = 5.8A 151W
제조사 : Sony Global Manufacturing & Operations Corporation Kosal Site
제조자/상표 : OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
제조년월 : 별도 표시
A/S 센터 : (82)2-6255-3200

IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1



R-41137871
www.bis.gov.in

제조공장 : Sony Global Manufacturing & Operations
Corporation Kosal Site



IPX1

MADE IN JAPAN
FABRIQUE AU JAPON
4-737-633-02

Рис. 16. Монитор медицинский 4K UHD OEV321UH. Маркировка на устройстве.



Рис. 17. Шнур питания переменного тока. Первичная упаковка.



Рис. 18. Шнур питания переменного тока.



Рис. 19. Держатель для вилки для поставляемого шнура питания переменного тока.



Рис. 20. Винты для крепления VESA.

Рис. 21. Инструкция по эксплуатации.

OLYMPUS

Инструкция по эксплуатации

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ 4K UHD

OEV321UH



Номер по каталогу: RU-3402421

4K **HDMI** **CE**

Оглавление

Этикетки и символы

Важная информация –
прочтите перед
использованием

Особенности

Место расположения и
функции частей и средств
управления

Установка и
подключение

Проверка

Настройка

Поиск и устранение
неисправностей

Приложение

1

2

3

4

5

6

Рис. 22. Инструкция по эксплуатации.

OLYMPUS

— Производитель —

 **OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.**

2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, TOKYO 192-8507, JAPAN
Tel: +81 42 642-2111, Fax: +81 42 646-2429

— Дистрибутор —

   **OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG**

Wendelsstraße 14-16, 20097 HAMBURG, GERMANY
Postfach 10 49 08, 20034 HAMBURG, GERMANY
Tel: +49 40 23773-0

ООО ОЛИМПАС МОСКВА

107023 Россия г. МОСКВА, ул. Электроавтомобилей, д. 27-стр. 8
Тел: +7 495 926 70 77

Дата выпуска 2005-07-02
РА0004 01

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
23 листов



Данилова А.Е.