



Р-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

123154, г. Москва, ул. Берзарина,

д. 19, корп. 1

+7 (495) 956 79 37

info@rpharm.ru

УТВЕРЖДАЮ

Младший специалист группы
регистрации медицинских изделий
Департамента регистрации
лекарственных средств и медицинских
изделий Медицинской дирекции
АО «Р-Фарм»

Е.М. Чикунова
«10» апреля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Процессоры ультразвуковые эндоскопические

2024



Процессоры ультразвуковые эндоскопические, вариант исполнения: SP-900 (вид спереди)



Процессоры ультразвуковые эндоскопические, вариант исполнения: SP-900 (вид сзади)

FUJIFILM Corporation

405N202506A

Ultrasonic Processor SP-900

50/60Hz
100-240V ~
0.7-0.5A

CE 0197



SP-900


SN



Процессоры ультразвуковые эндоскопические, вариант исполнения: SP-900 (макет заводской таблички)

FUJIFILM


Ultrasonic Processor SP-900




CE 0197 MD



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany



FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen, Switzerland

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
54 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113
Australia

製造販売業者 :
富士フイルム株式会社
神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

SP-900

SN *V647****



YYYY-MM-01

UDI



(01)*****
(11)YYMM01
(21)*V647****

SP-900 FV647A //E PI-0

BN YYYYMMDD

Процессоры ультразвуковые эндоскопические, вариант исполнения: SP-900 (макет маркировки транспортной упаковки)

Процессор ультразвуковой эндоскопический SP-900

Производитель: ФУДЖИФИЛЬМ FUJIFILM
Корпорейшн, Corporation,


Страна происхождения: Япония Japan

**Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:** АО «Р-Фарм»
123154, Москва,
ул. Берзарины, д. 19, корп. 1,
тел. 8-495-956-79-37
факс: 8-495-956-79-38
e-mail: info@rpharm.ru

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Процессоры ультразвуковые эндоскопические, вариант исполнения: SP-900 (макет маркировки на русском языке)

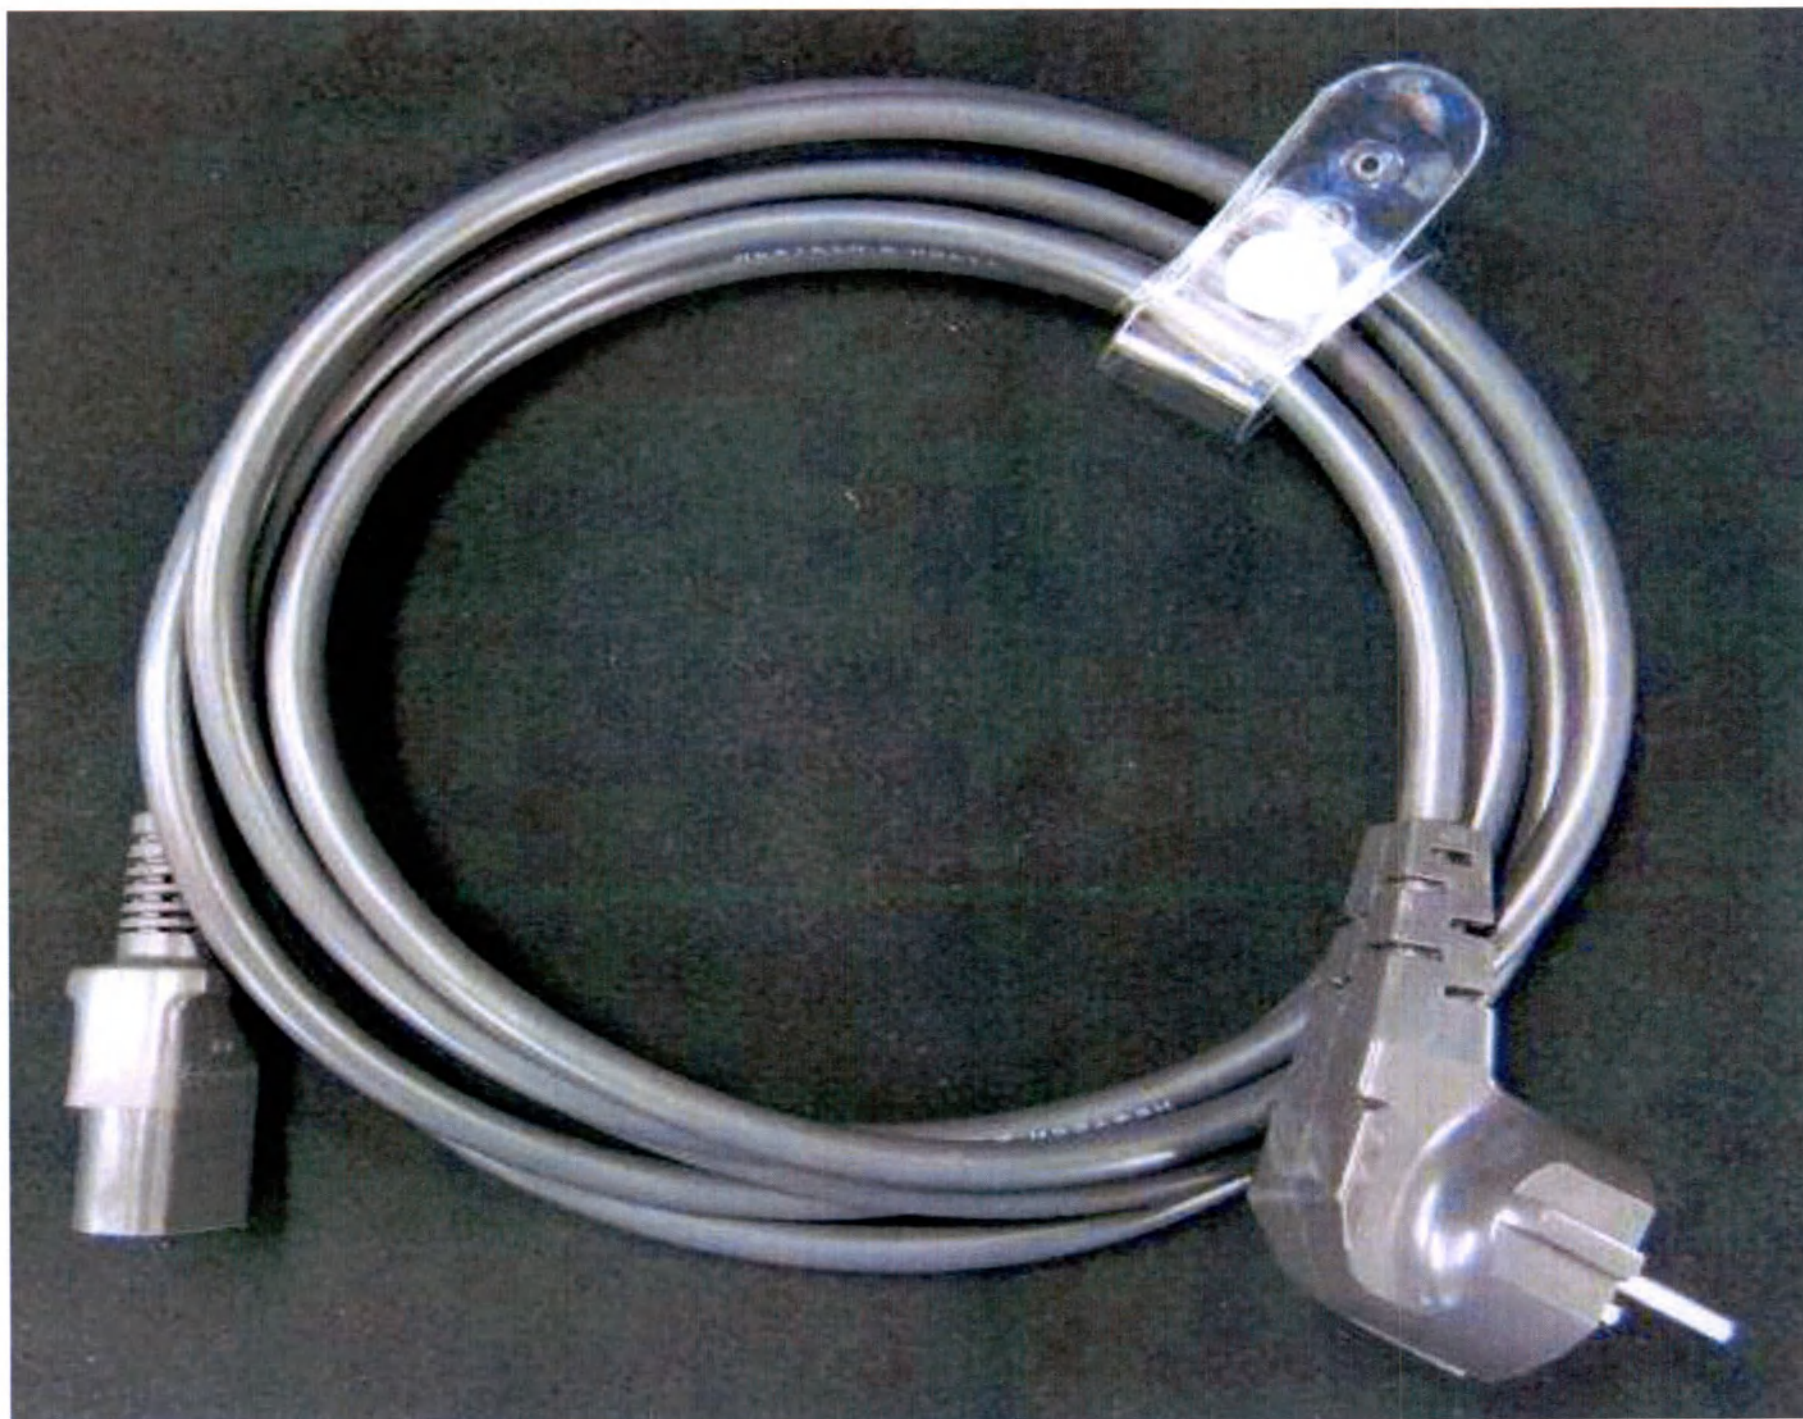

Кабель питания

FUJIFILM

Русская версия

Процессор ультразвуковой эндоскопический с
принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


SP-900

Спасибо за покупку нашего прибора. Перед
началом работы с ним внимательно прочтите
данное руководство, чтобы избежать
несчастных случаев и раскрыть все его
возможности.


897N120838D

CE 0123


Руководство по эксплуатации

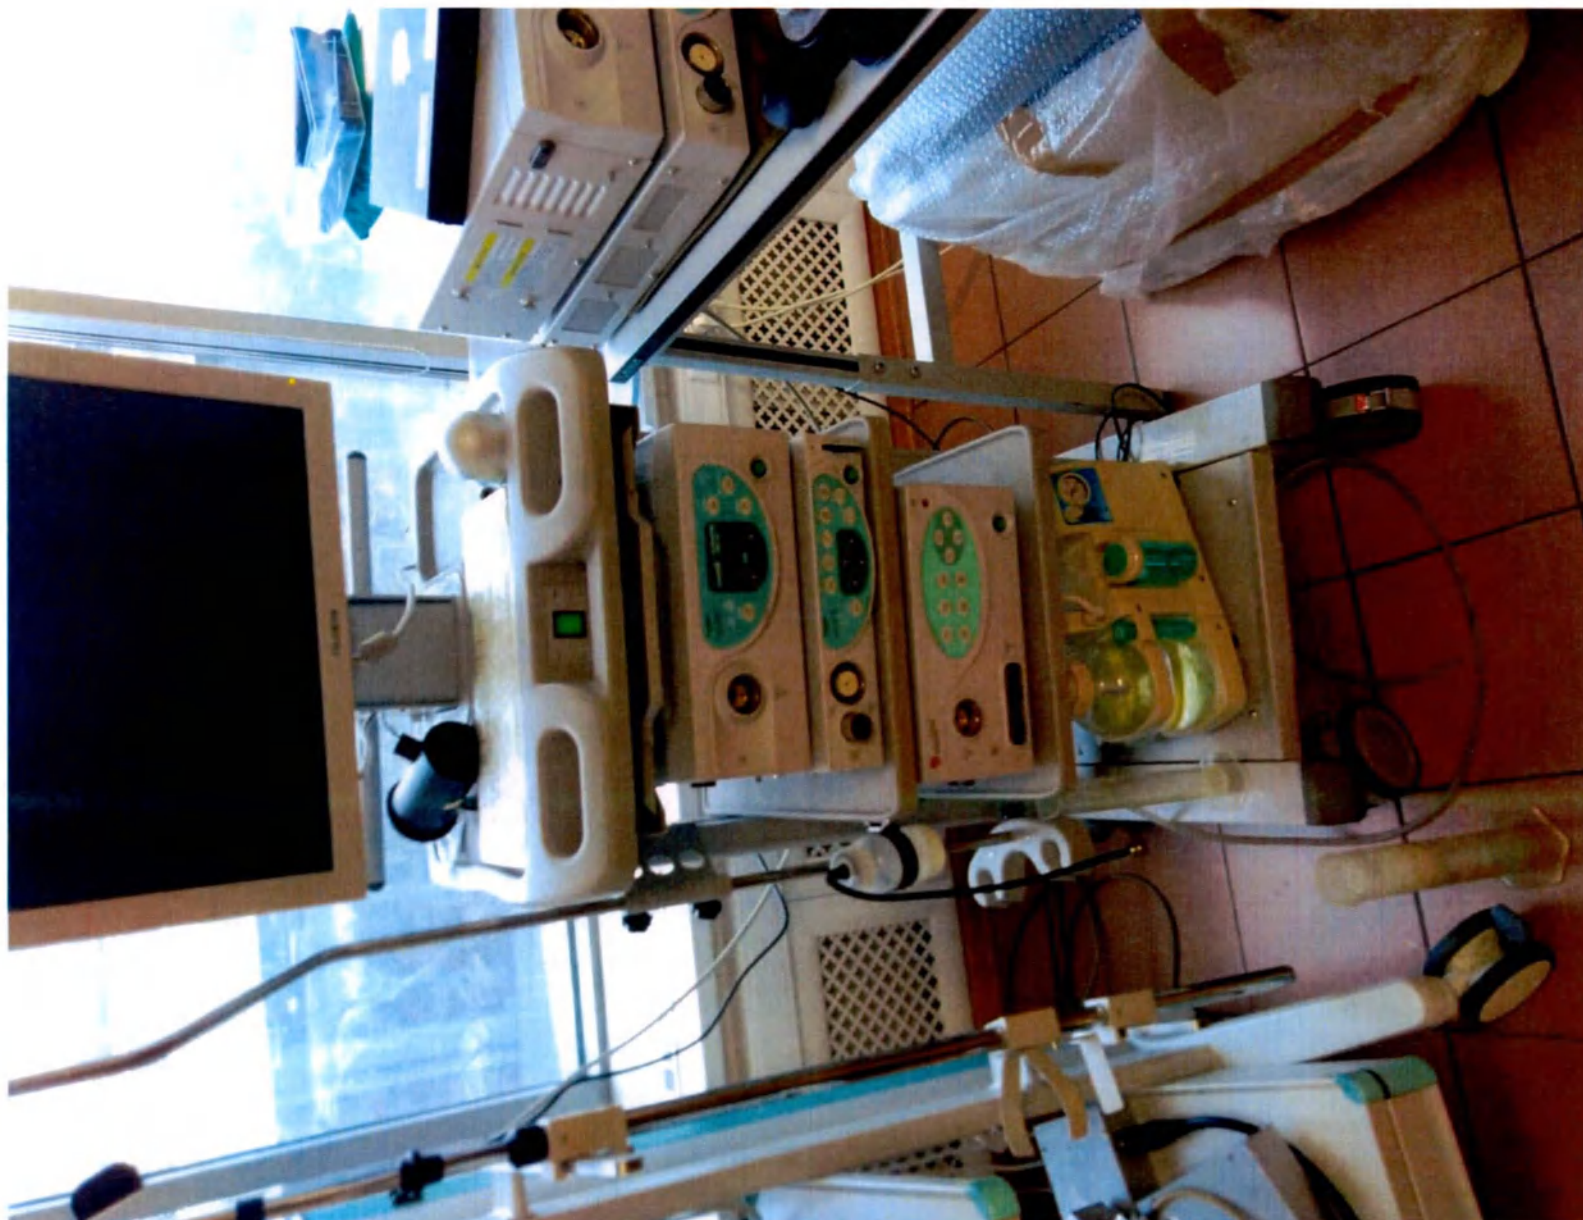


Тележка установочная: PC-410.

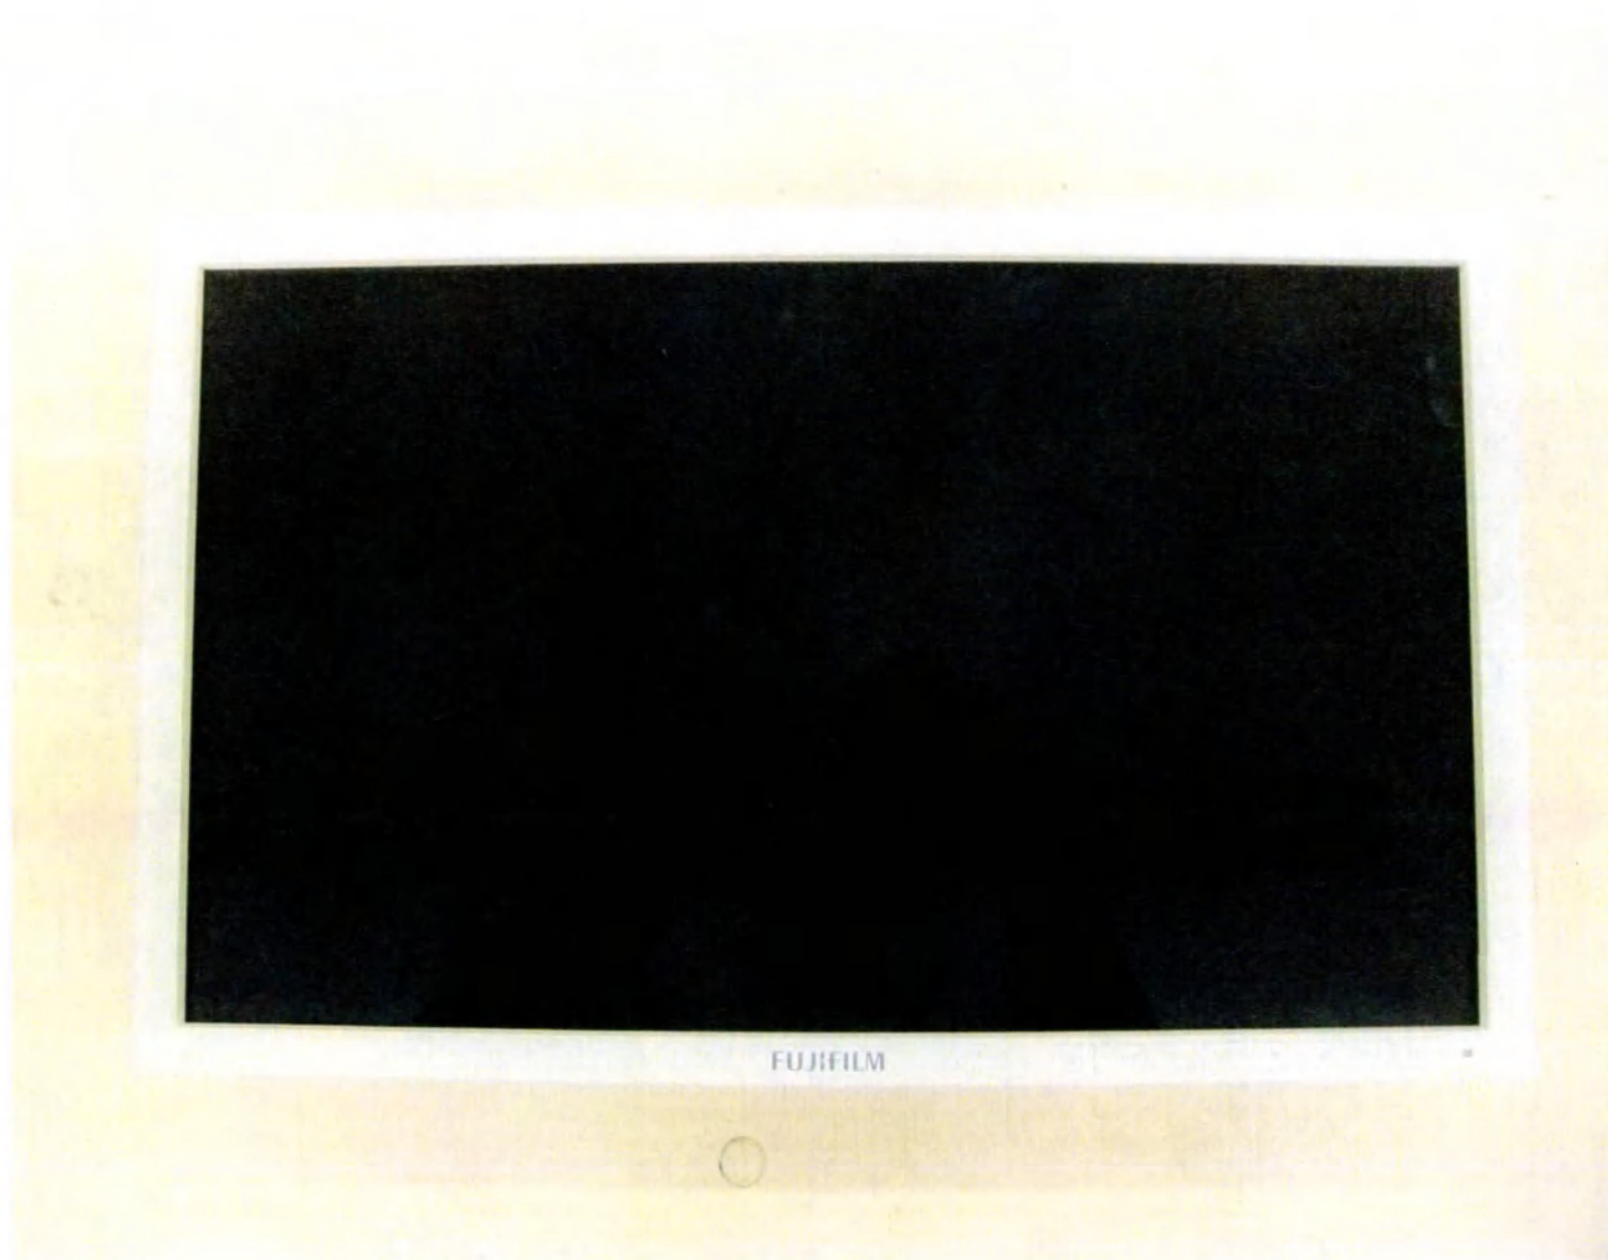

Видеомониторы жидкокристаллические эндоскопические, в исполнении: CL-22

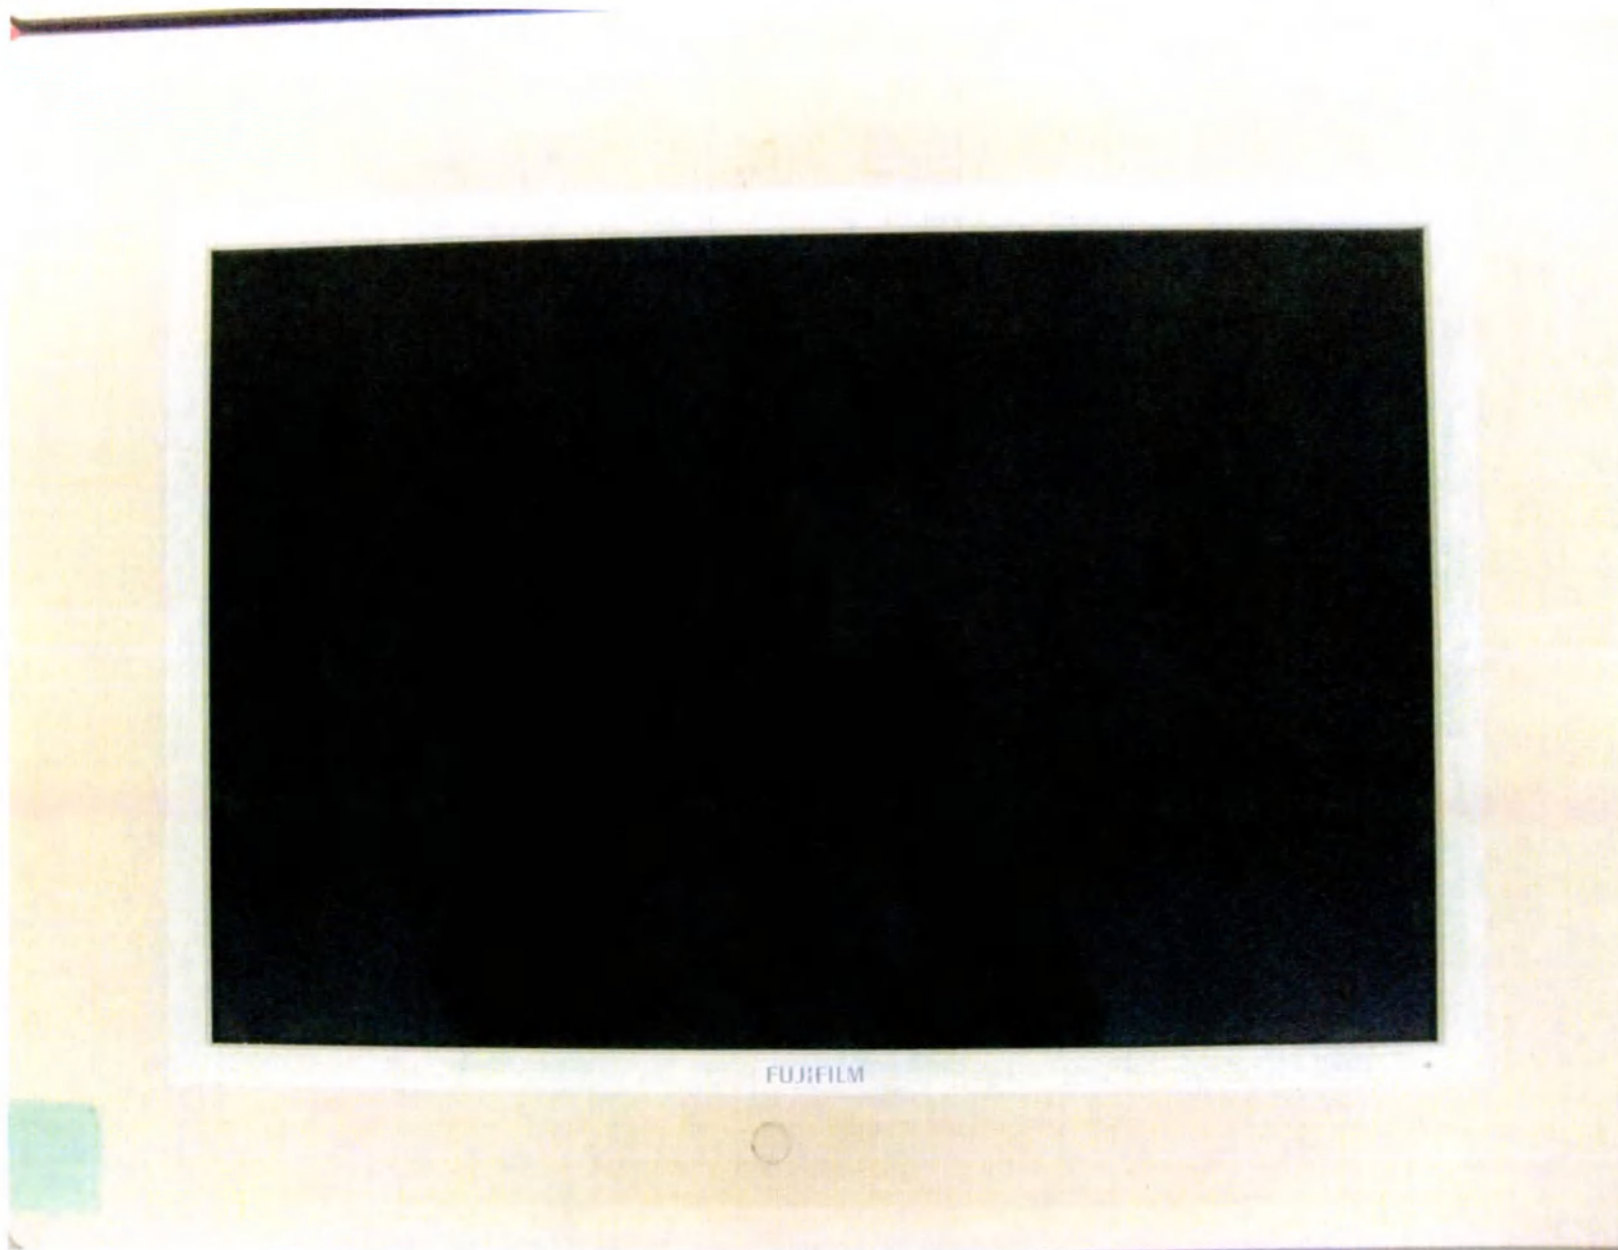


Видеомониторы жидкокристаллические эндоскопические, в исполнении: CL-24

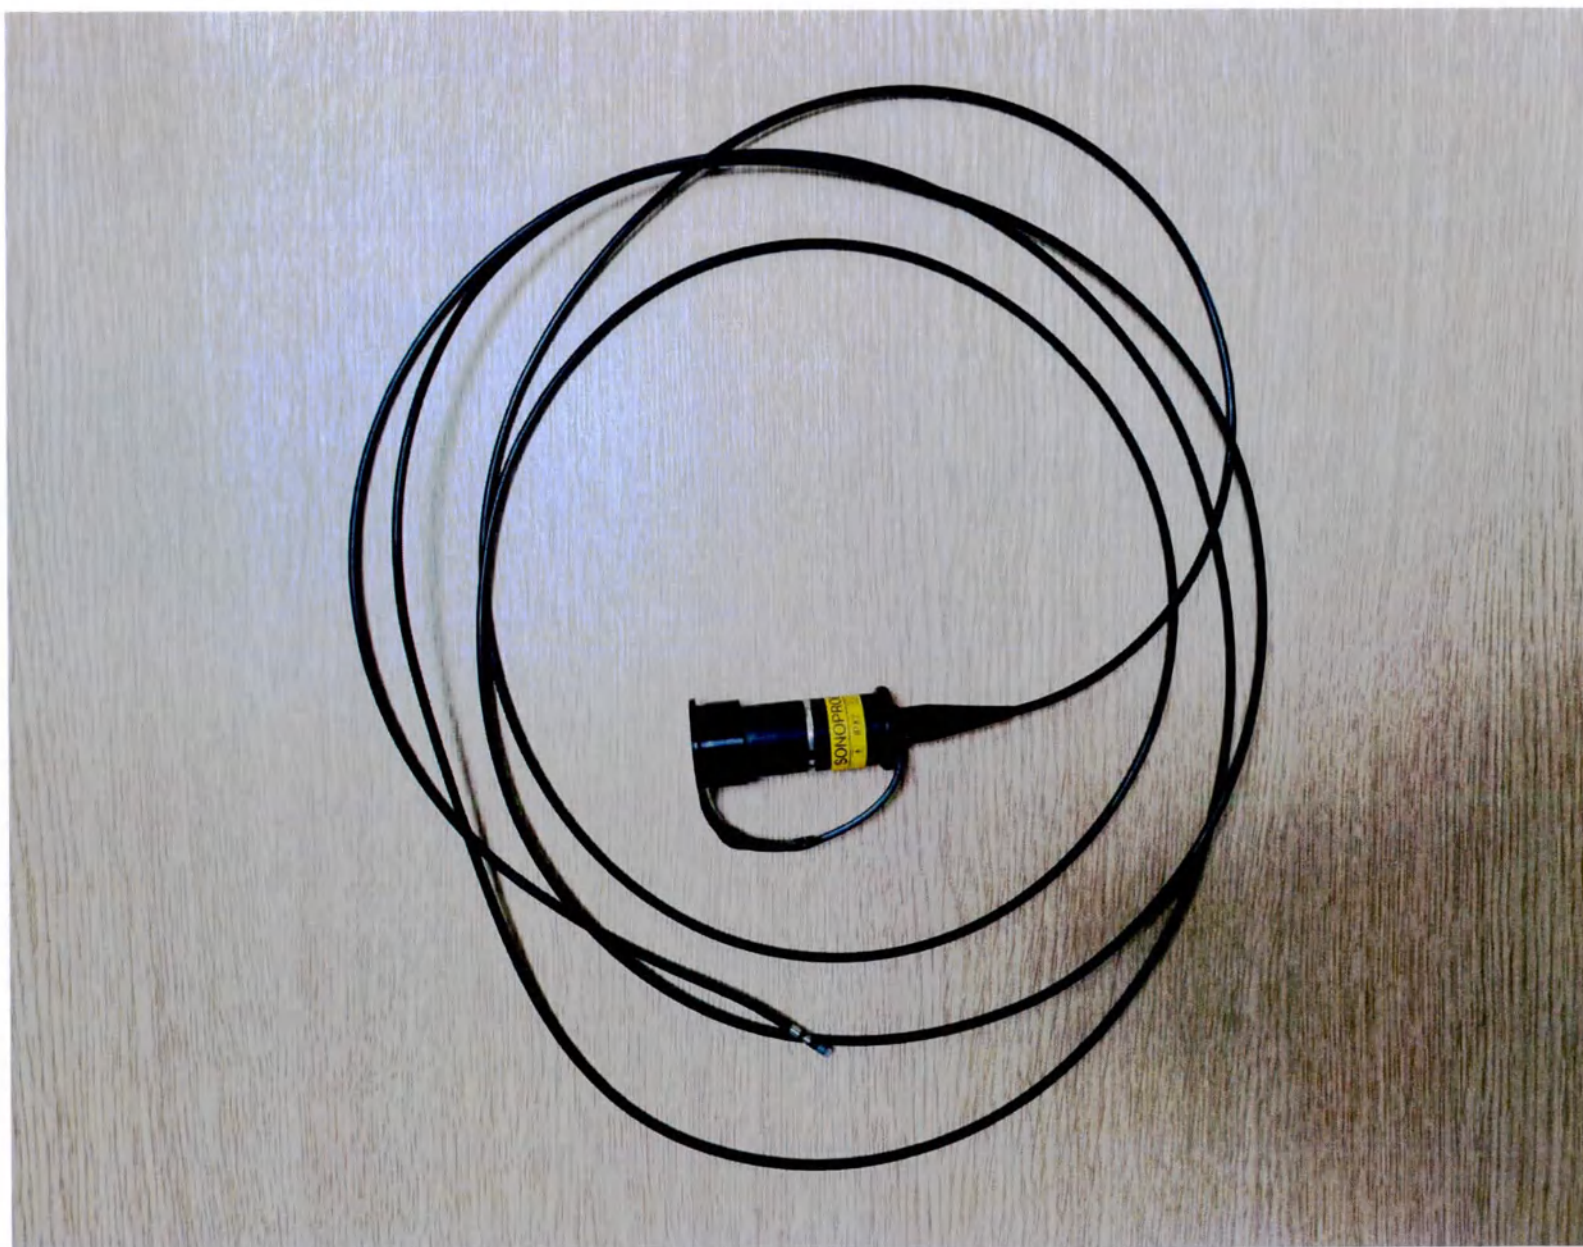

Датчики для ультразвукового процессора эндоскопического, в исполнении: P2620-L (общий вид)



Датчики для ультразвукового процессора эндоскопического, в исполнении: P2620-L (соединитель)

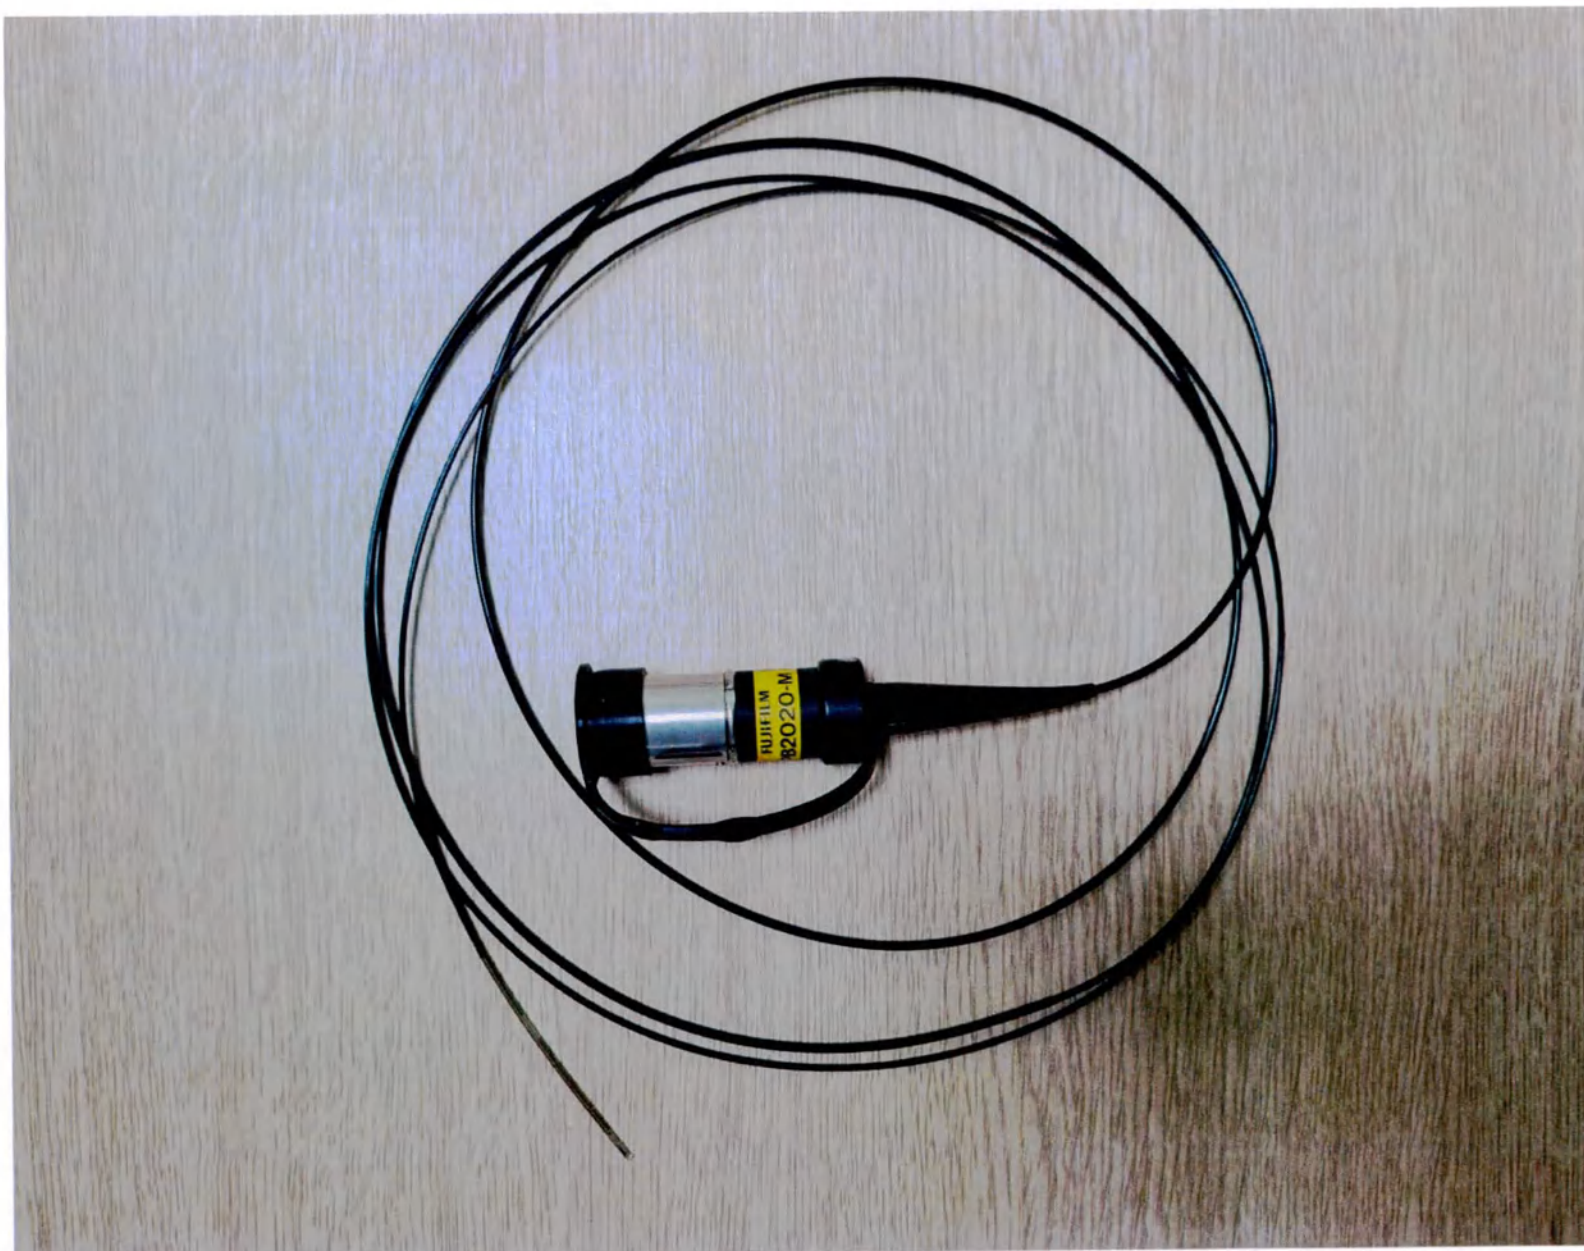


Датчики для ультразвукового процессора эндоскопического, в исполнении: RB2020-M (общий вид)




Датчики для ультразвукового процессора эндоскопического, в исполнении: PB2020-M (соединитель)




Сканер RS-900.

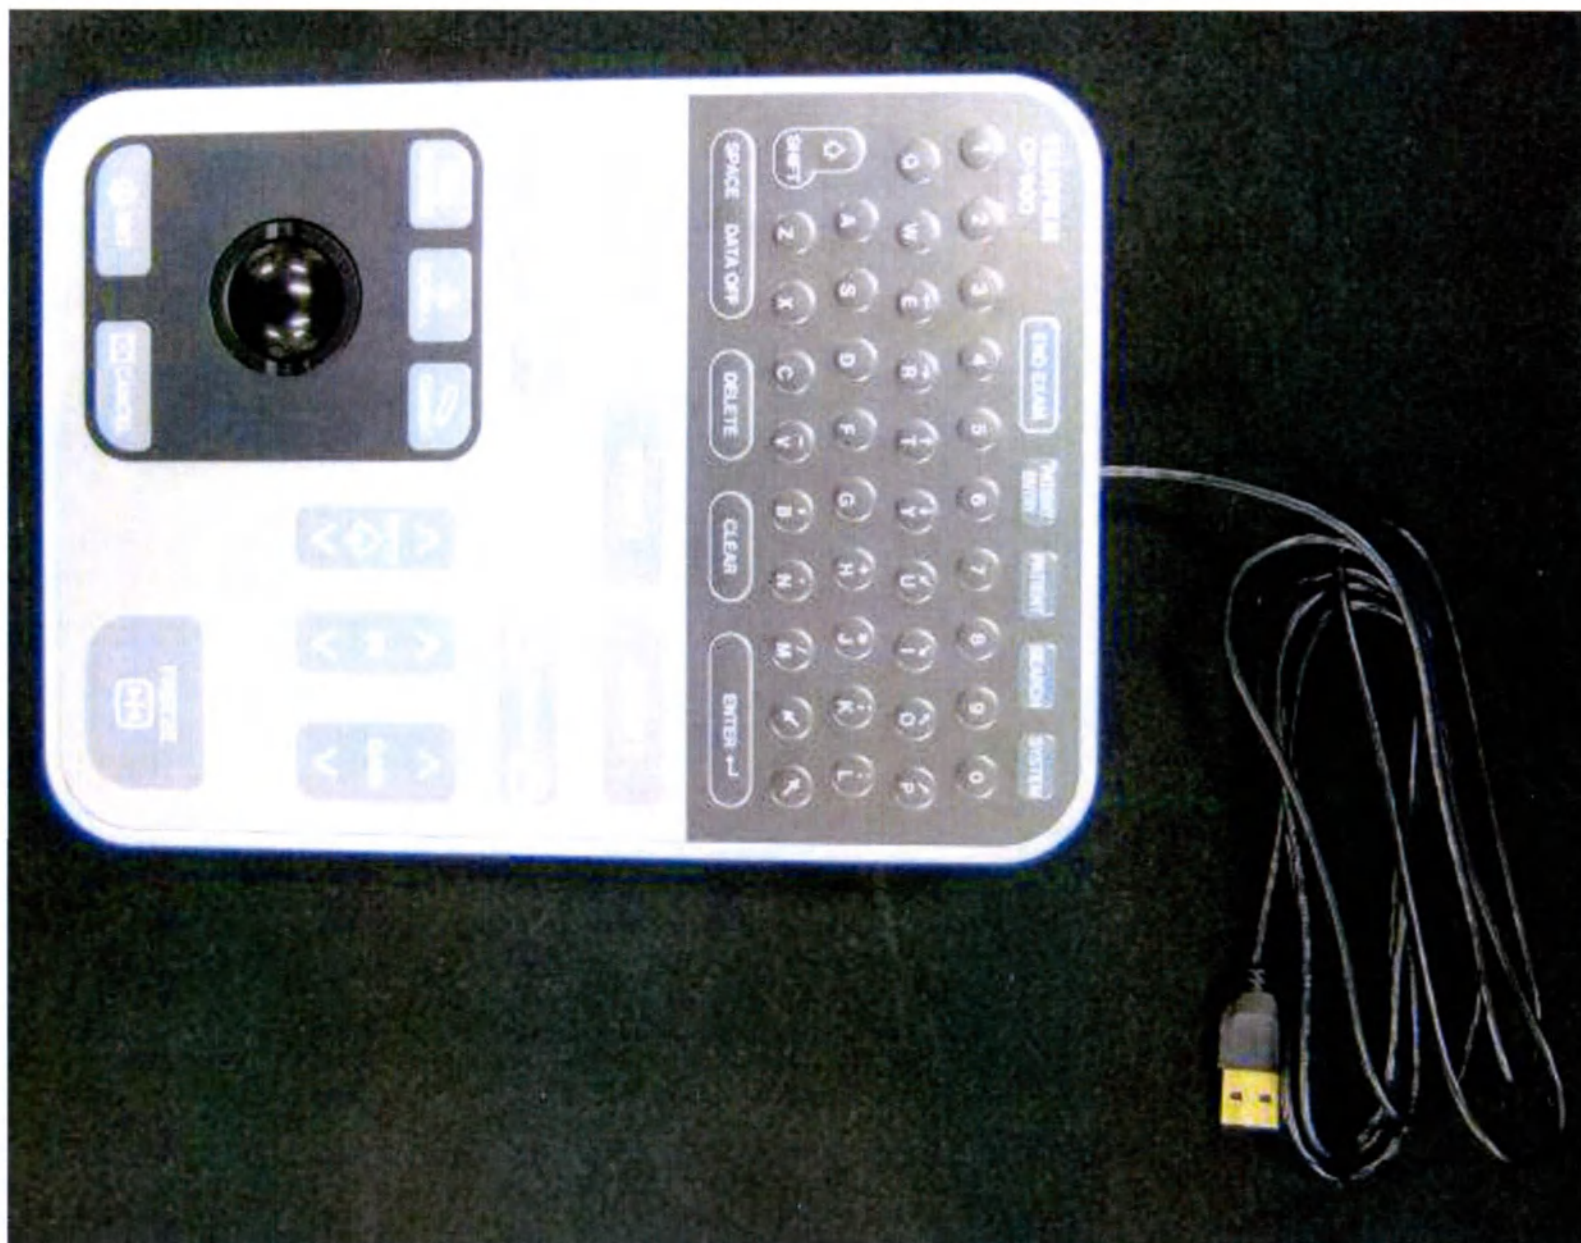


Клавиатура для ультразвуковых процессоров, в исполнении: CP-900

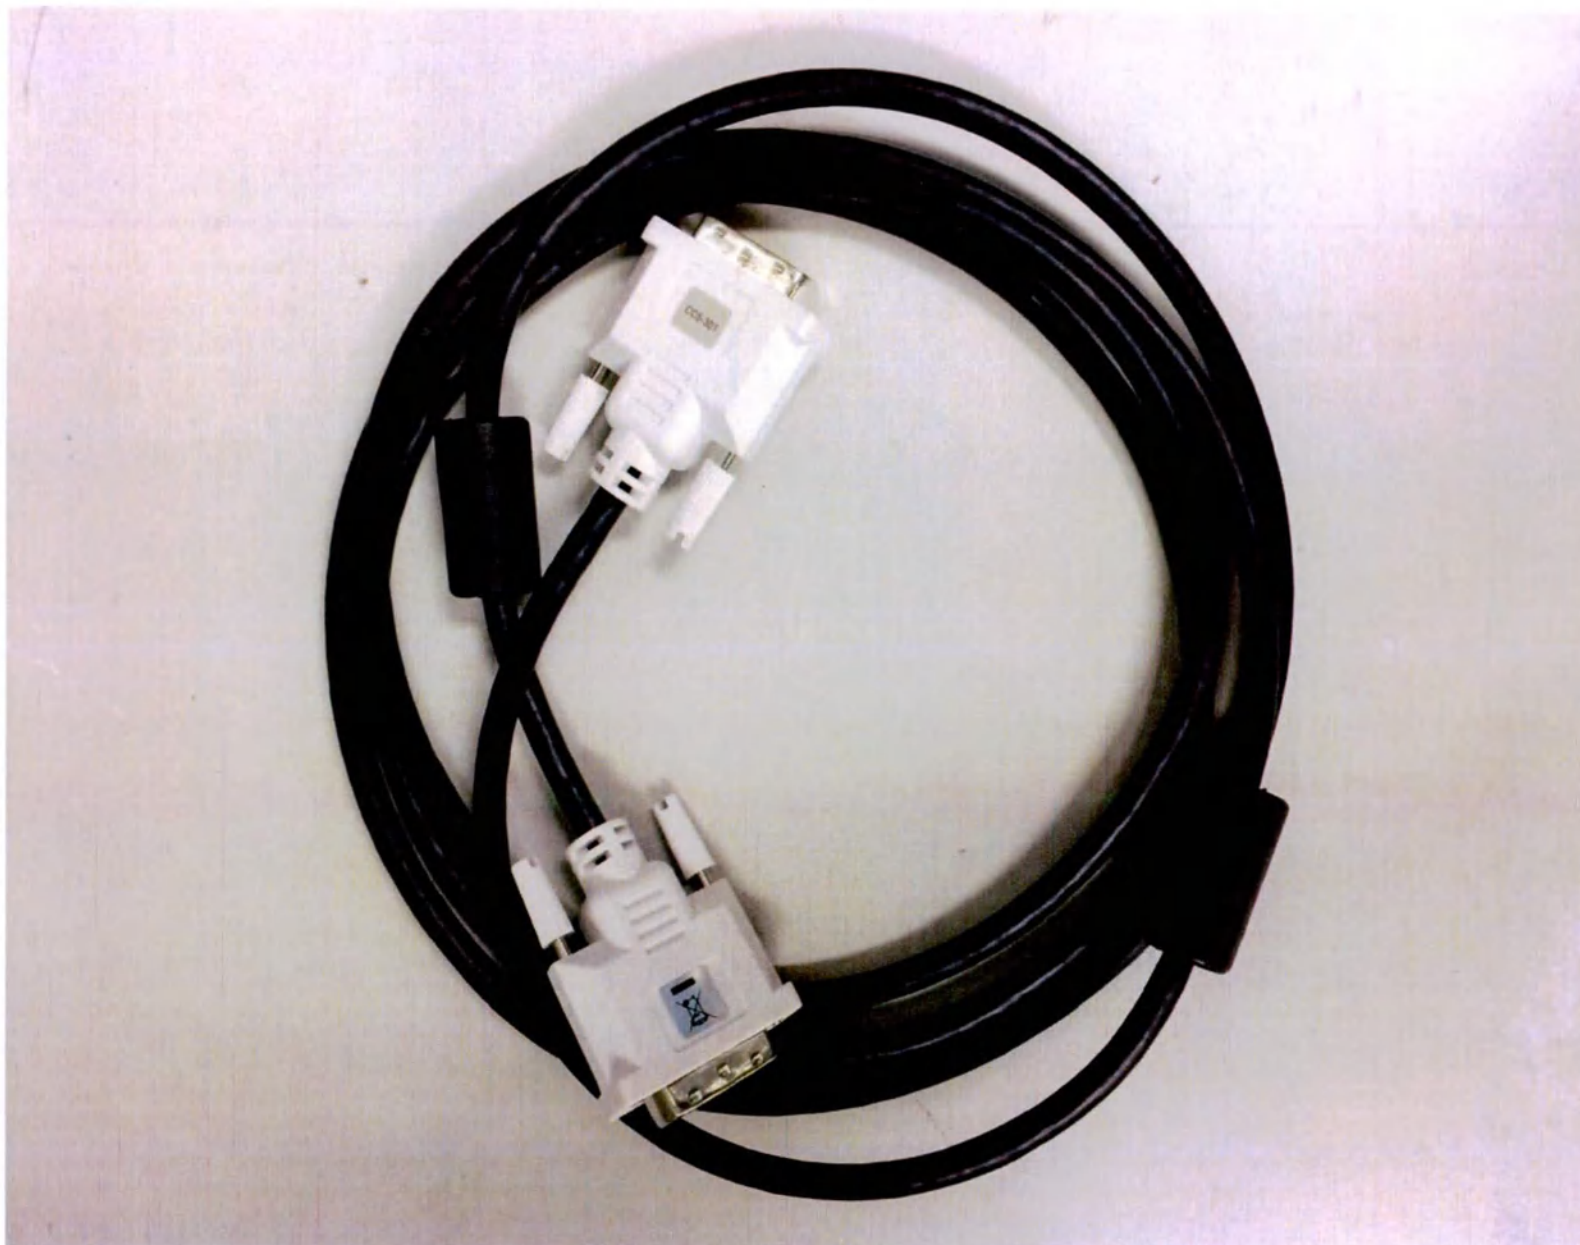


Кабели соединительные, в исполнениях: CC5-301

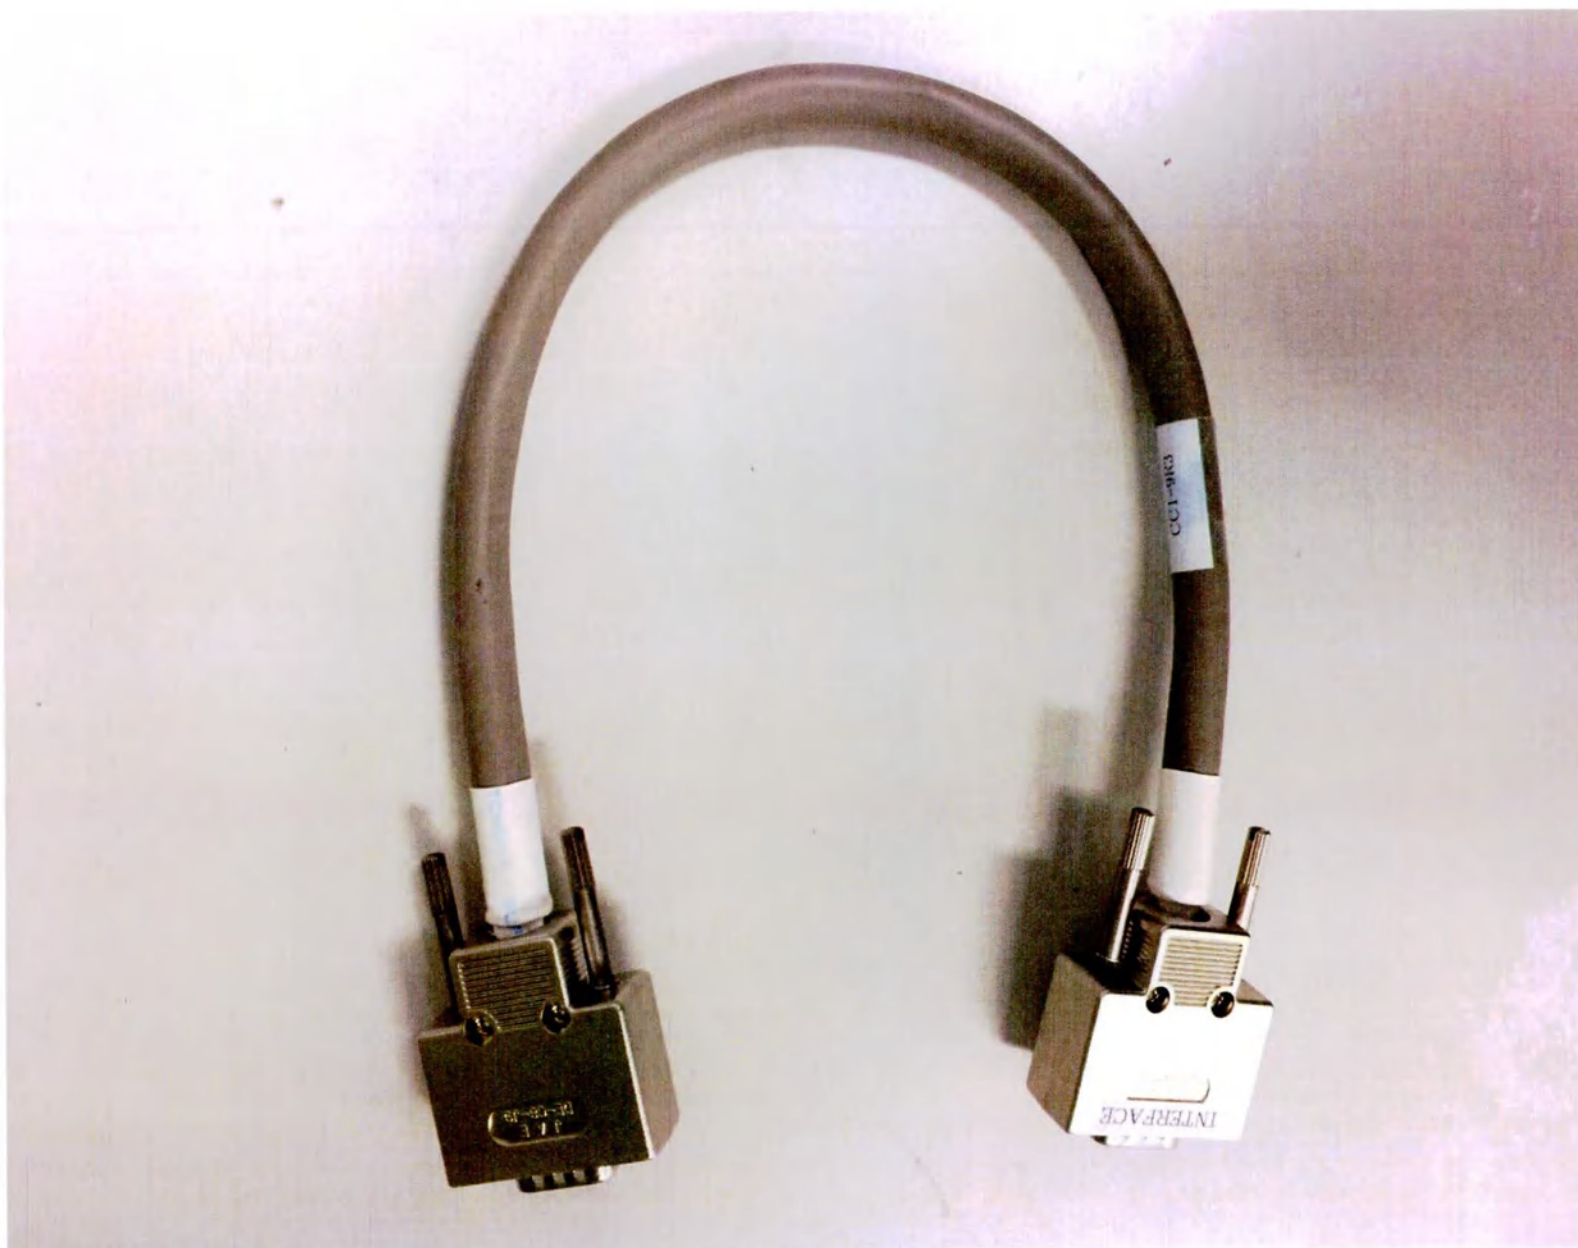

Кабели соединительные, в исполнениях: CC1-9R3

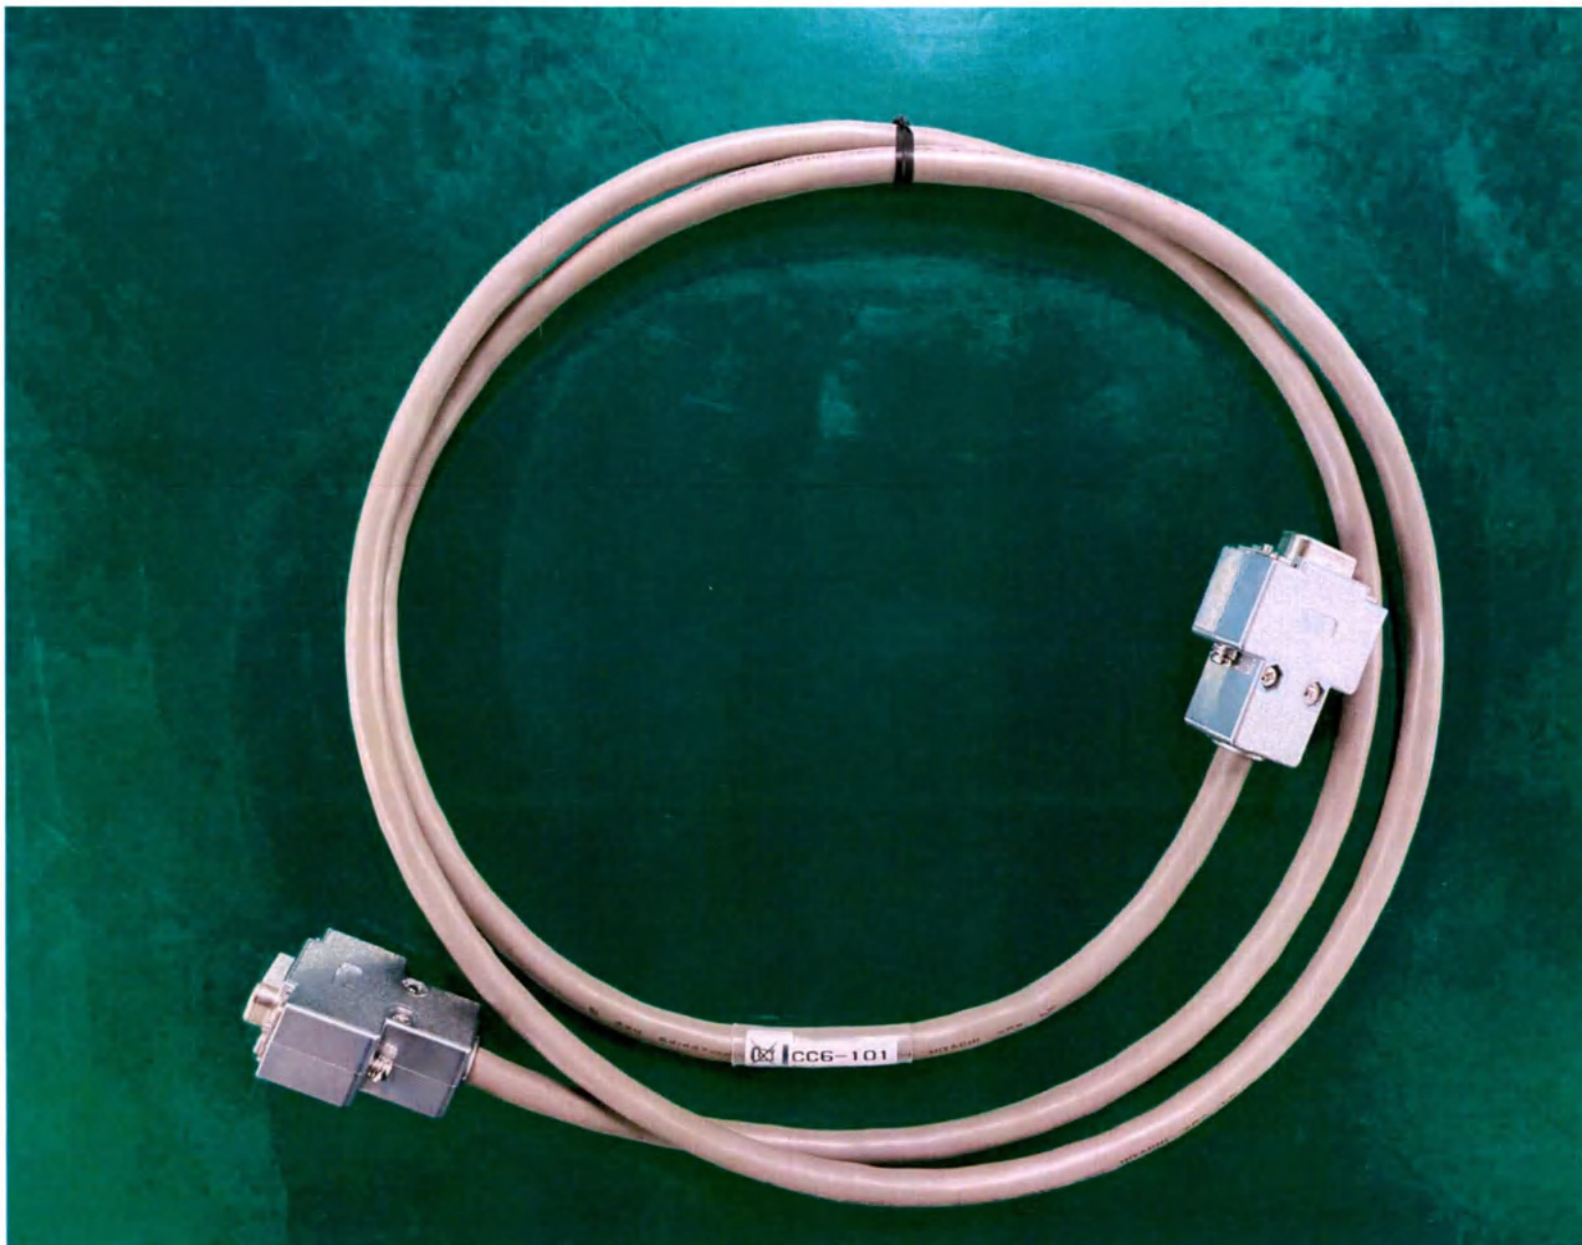

Кабели соединительные, в исполнениях: CC6-101

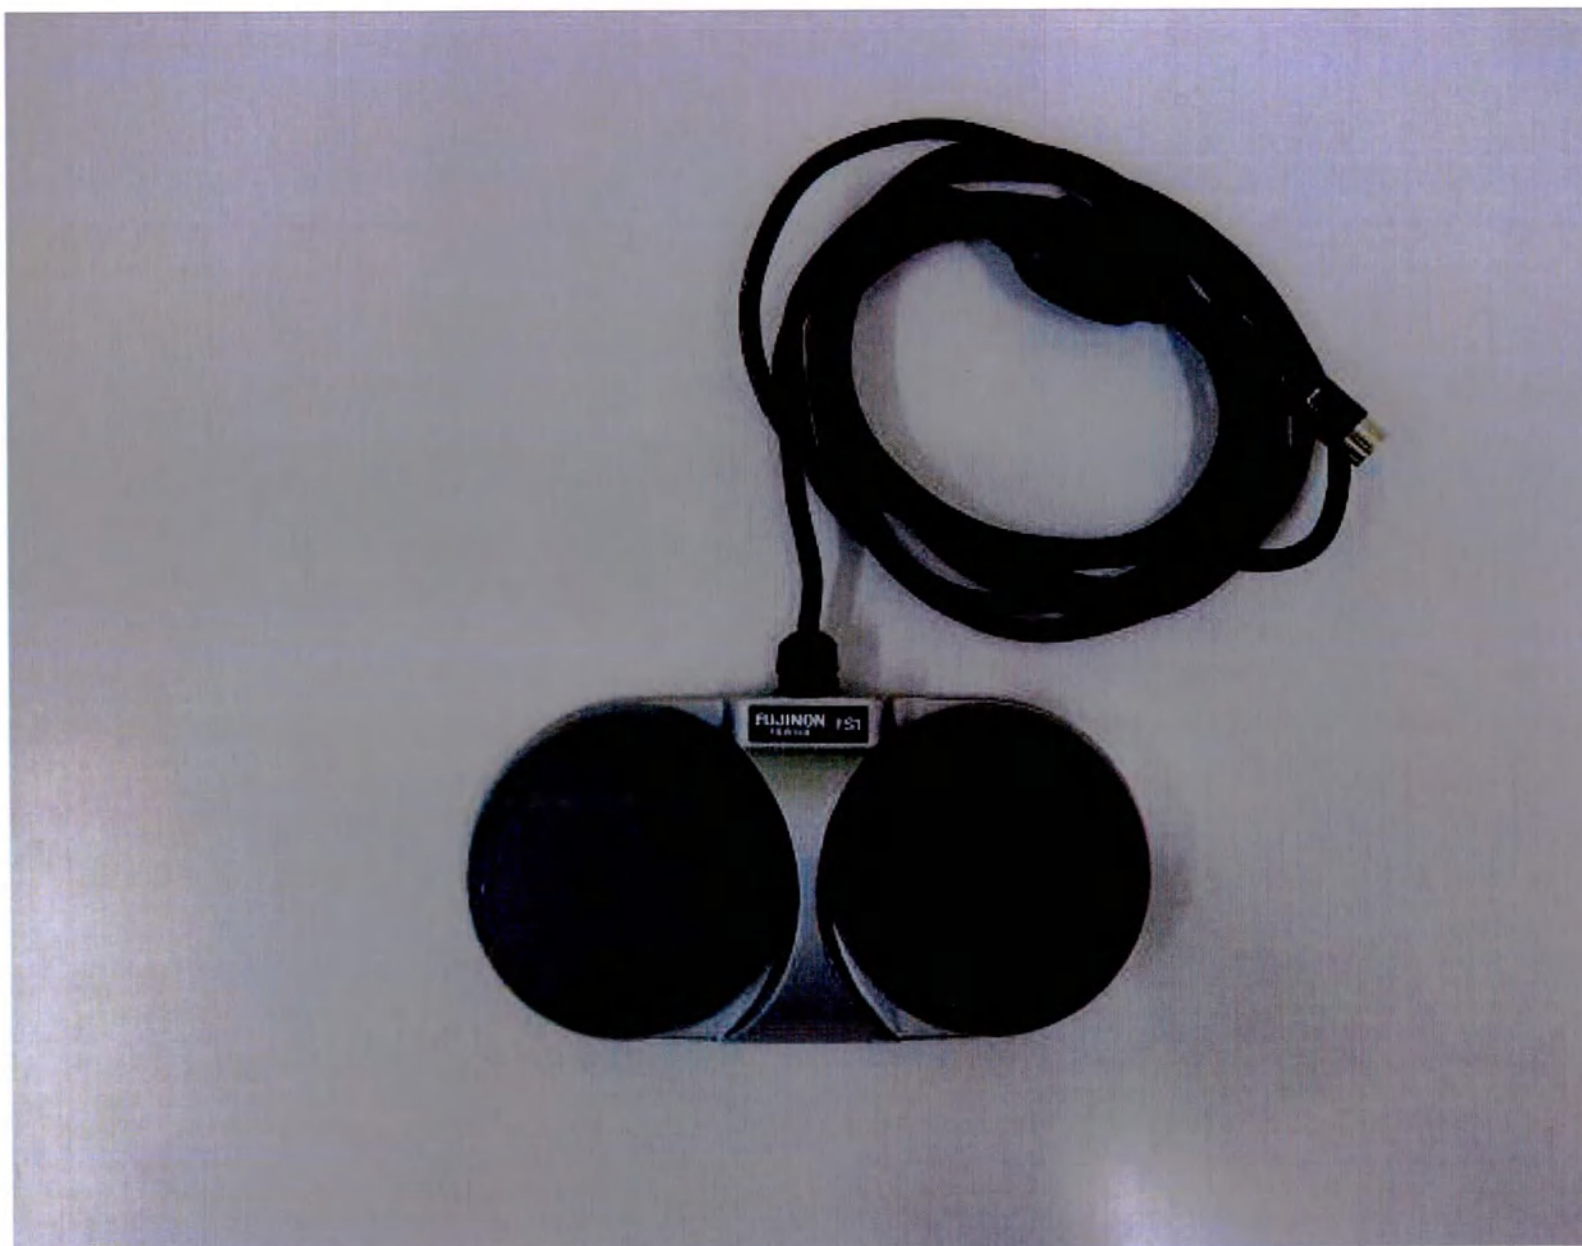

Педал дистанционного управления для процессоров ультразвуковых эндоскопических FS-1.



Карта памяти типа Compact Flash для ультразвукового процессора

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 22

(двадцати двух) листах



Смирнов Е.Н.