

Аппарат
искусственной вентиляции легких
ZISLINE в исполнениях
MV200, MV300, MV350

Паспорт
ТЭСМ.941144.001 ПС

Редакция 3, 08/2024

Паспорт, ТЭСМ.941144.001 ПС, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

Аппарат
искусственной вентиляции легких
ZISLINE в исполнениях
MV200, MV300, MV350

Руководство по эксплуатации
ТЭСМ.941144.001 РЭ

Редакция 4, 08/2024

Руководство по эксплуатации, ТЭСМ.941144.001 РЭ,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

Прошито, пронумеровано,
скреплено печать 2 листа
Генеральный директор
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

Полунин В. М

«01» ноября 2024г.



ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 1 из 40 Ревизия: 6
---------------------	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Начальник КБ



Булаев В.В.

Данные о маркировке и упаковке.

Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350

Разработал:

Ведущий инженер-конструктор
Конов Е.Д.

Дата: 09.08.2024

Проверил:

Начальник отдела НДА
Алексеев К.А.

Дата: 09.08.2024

Согласовано:

Ведущий инженер-конструктор
Кованешникова Е.А.

Дата: 09.08.2024

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 2 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---------------------------------

1 Маркировка аппарата


№ п/п	Наименование (вариант исполнения)	Обозначение	
		Товарный знак	
		Triton	Treaton
1	Наклейка на заднюю панель (исполнение MV200)	ТЭСМ.239902	ТЭСМ.239902-05
2	Наклейка на заднюю панель (исполнение MV300)	ТЭСМ.239902-02	ТЭСМ.239902-04
3	Наклейка на заднюю панель (исполнение MV350)	ТЭСМ.239902-08	ТЭСМ.239902-07
4	Наклейка «Индикация» (исполнения MV200, MV300)	ТЭСМ.239901	
5	Наклейка «Индикация» (исполнение MV350)	ТЭСМ.239915	
6	Наклейка «Ethernet»	ТЭСМ.189937	
7	Наклейка дисплея (исполнение MV200)	ТЭСМ.189927	ТЭСМ.189927-01
8	Наклейка дисплея (исполнения MV200, MV300)	ТЭСМ.239931	ТЭСМ.239931-01
9	Шильд	ТЭСМ.239908	ТЭСМ.239918
10	Наклейка «Кнопки управления» (исполнения MV200, MV300)	ТЭСМ.239900	
11	Корпус нижний (исполнения MV200, MV300)	ТЭСМ.239614	
12	Корпус нижний (исполнение MV350)	ТЭСМ.239632	
13	Панель разъемов (исполнение MV350)	ТЭСМ.239634	
14	Корпус задний	ТЭСМ.239615	
15	Наклейка «СТОП» (Вход свежего газа- Не перекрывать!)	ТЭСМ.709911	
16	Этикетка пломбировочная	TECH.239941	
17	Панель лицевая (исполнение MV200)	ТЭСМ.189614-02	ТЭСМ.189614-01
18	Панель лицевая (исполнение MV300)	ТЭСМ.239618-02 или ТЭСМ.239618-06	ТЭСМ.239618-01 или ТЭСМ.239618-05
19	Панель лицевая (исполнение MV350)	ТЭСМ.239618-03 или ТЭСМ.239628-07	ТЭСМ.239618-04 или ТЭСМ.239618-08

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 3 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---------------------------------

ТЭСМ.239902




ТЭСМ.239902-02

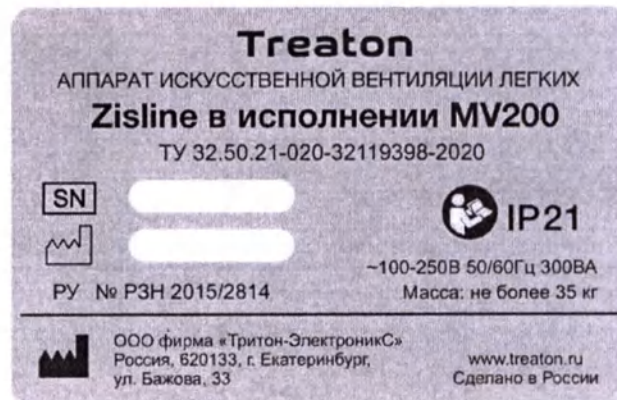

ТЭСМ.239902-05



ТЭСМ.239902-04

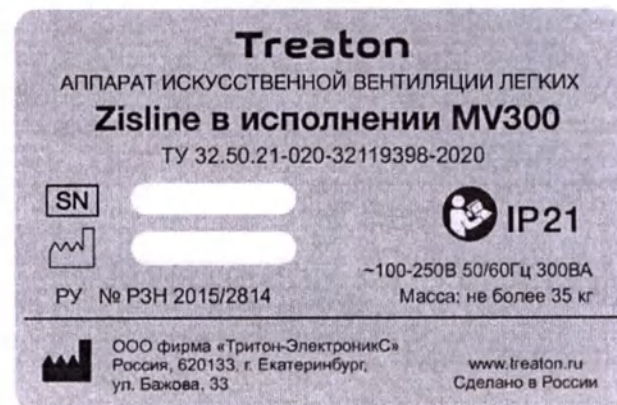


ТЭСМ.239902-08




ТЭСМ.239902-07



ТЭСМ.239901

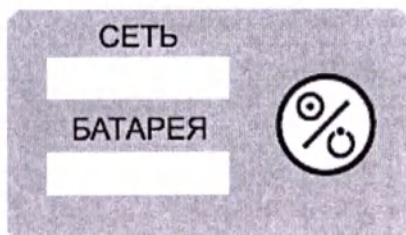


ТЭСМ.239915

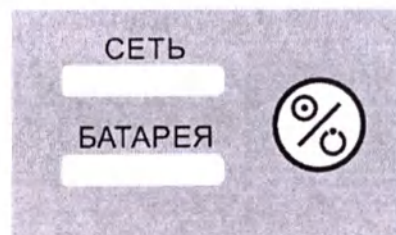

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 4 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---------------------------------

ТЭСМ.189937

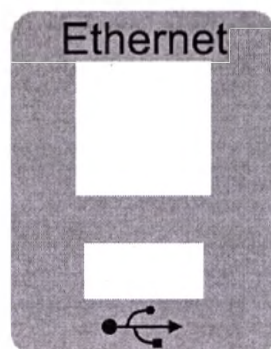

ТЭСМ.189927



ТЭСМ.189927-01




ТЭСМ.239931




ТЭСМ.239931-01



ТЭСМ.239908




ТЭСМ.239918




TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 5 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---------------------------------

ТЭСМ.239900

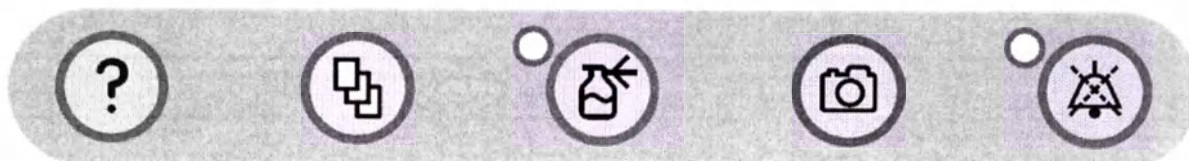


Корпус нижний ТЭСМ.239614*

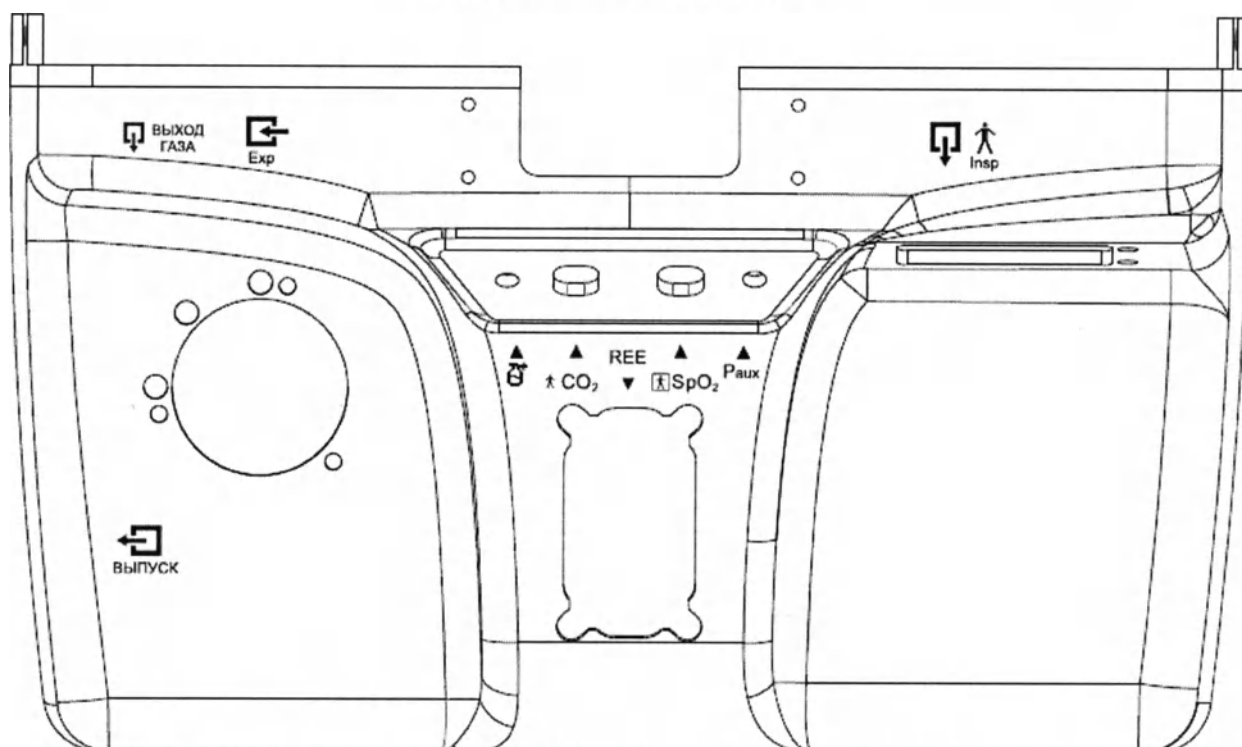

* - изображение маркировки в максимальной комплектации, набор символов может отличаться в зависимости от составных частей аппарата (определяются при заказе)


TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 6 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	--

Корпус нижний ТЭСМ.239632*

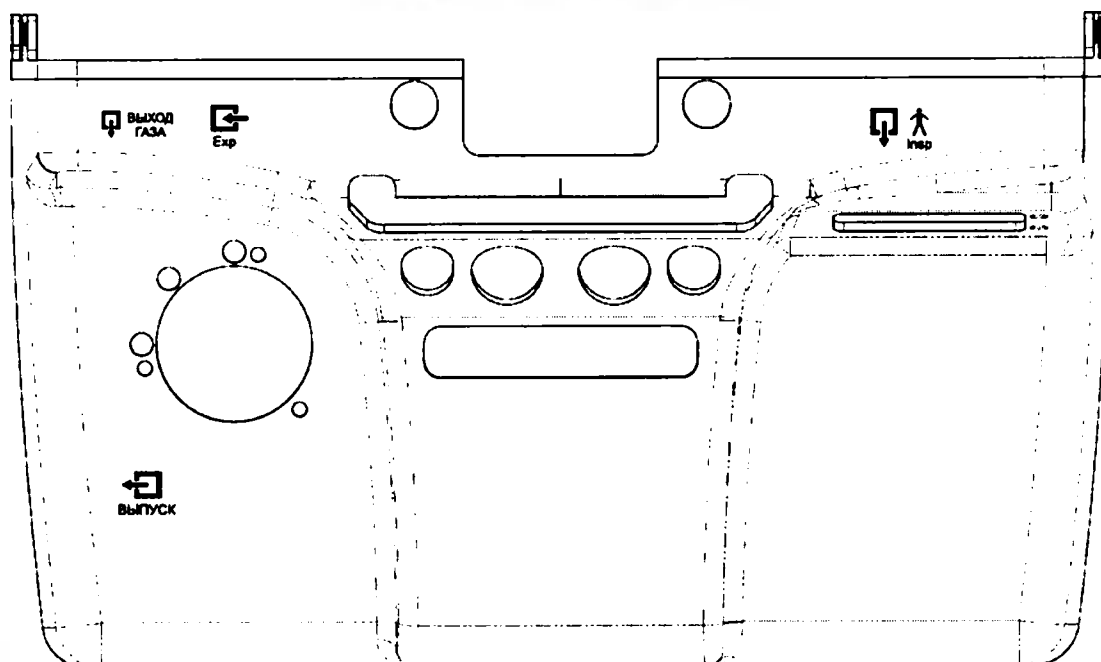

* - изображение маркировки в максимальной комплектации, набор символов может отличаться в зависимости от составных частей аппарата (определяются при заказе)


Панель разъемов ТЭСМ.239634*

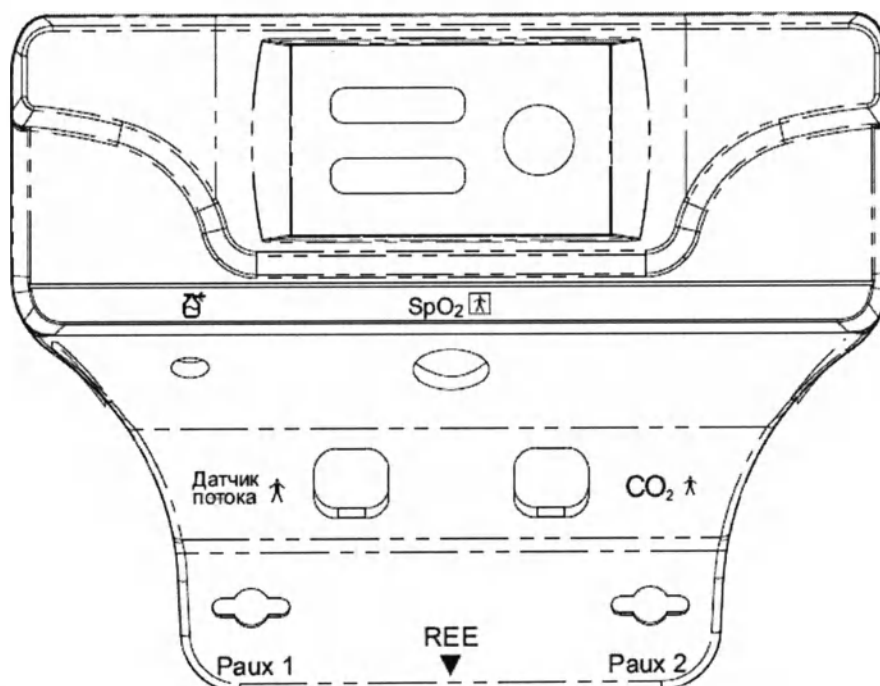

* - изображение маркировки в максимальной комплектации, набор символов может отличаться в зависимости от составных частей аппарата (определяются при заказе)


ТЭСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 7 из 40 Ревизия: 6
---------------------	--	--

Корпус задний ТЭСМ.239615*

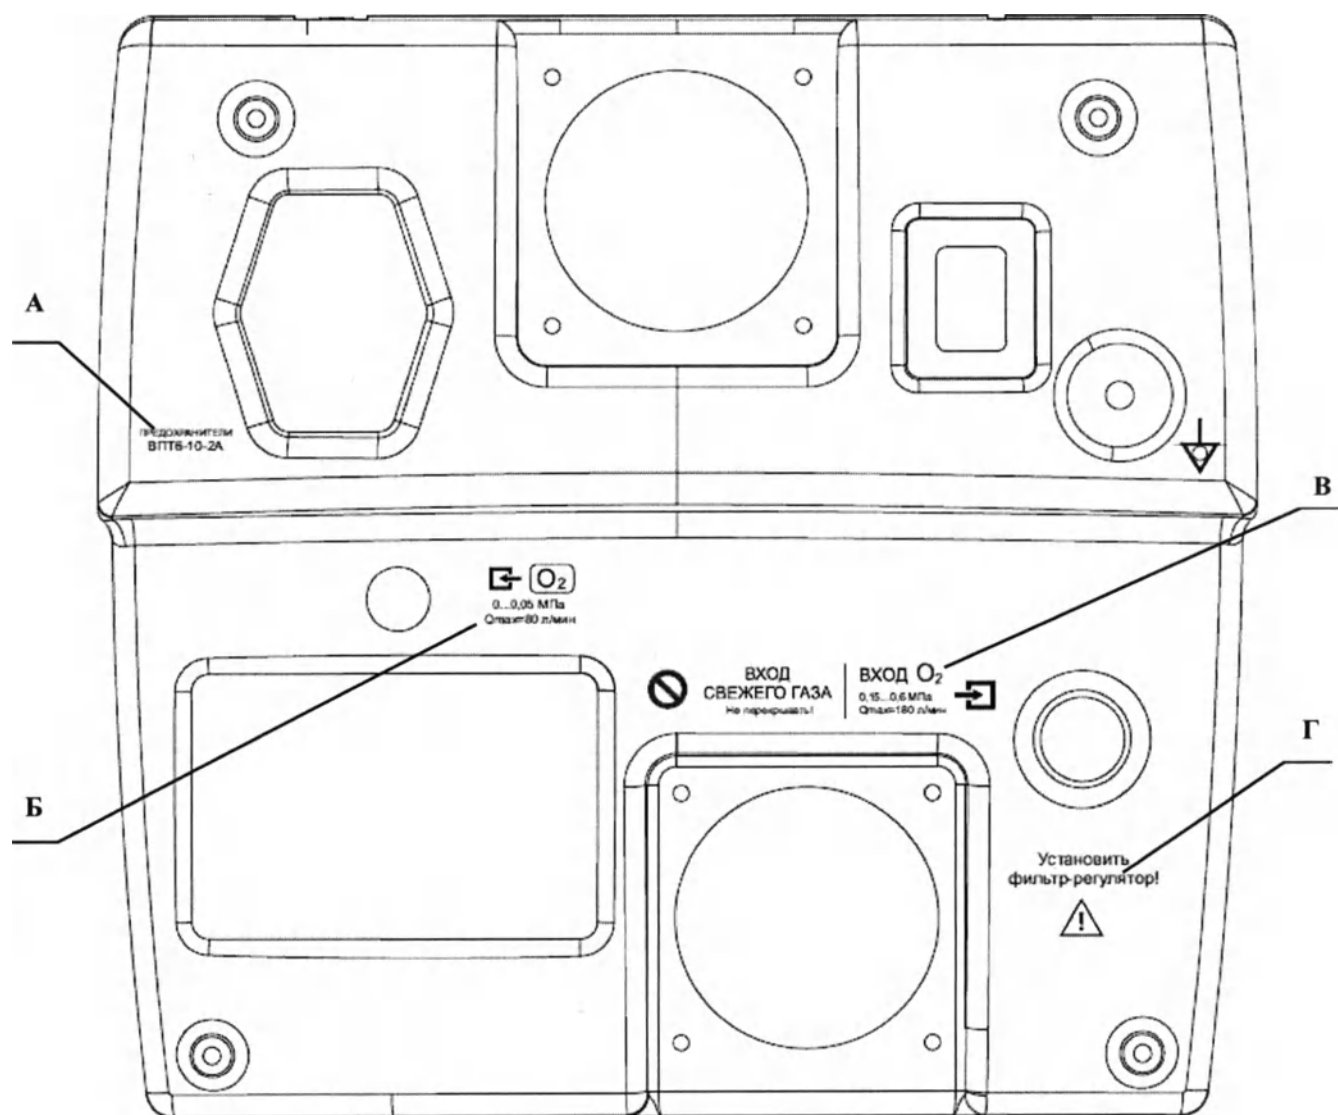

* - изображение маркировки в максимальной комплектации, набор символов может отличаться в зависимости от составных частей аппарата (определяются при заказе)

А ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ВПТ6-10-2А

Б  
0...0,05 МПа
Qmax=80 л/мин

В ВХОД
СВЕЖЕГО ГАЗА
Не перекрывать!

Г Установить
фильтр-регулятор!



ВХОД O₂
0,15...0,6 МПа
Qmax=180 л/мин




ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 8 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	--


ТЭСМ.709911



ТЭСМ.709911

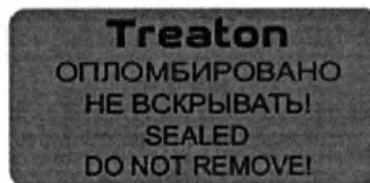


Панель лицевая ТЭСМ.189614-02

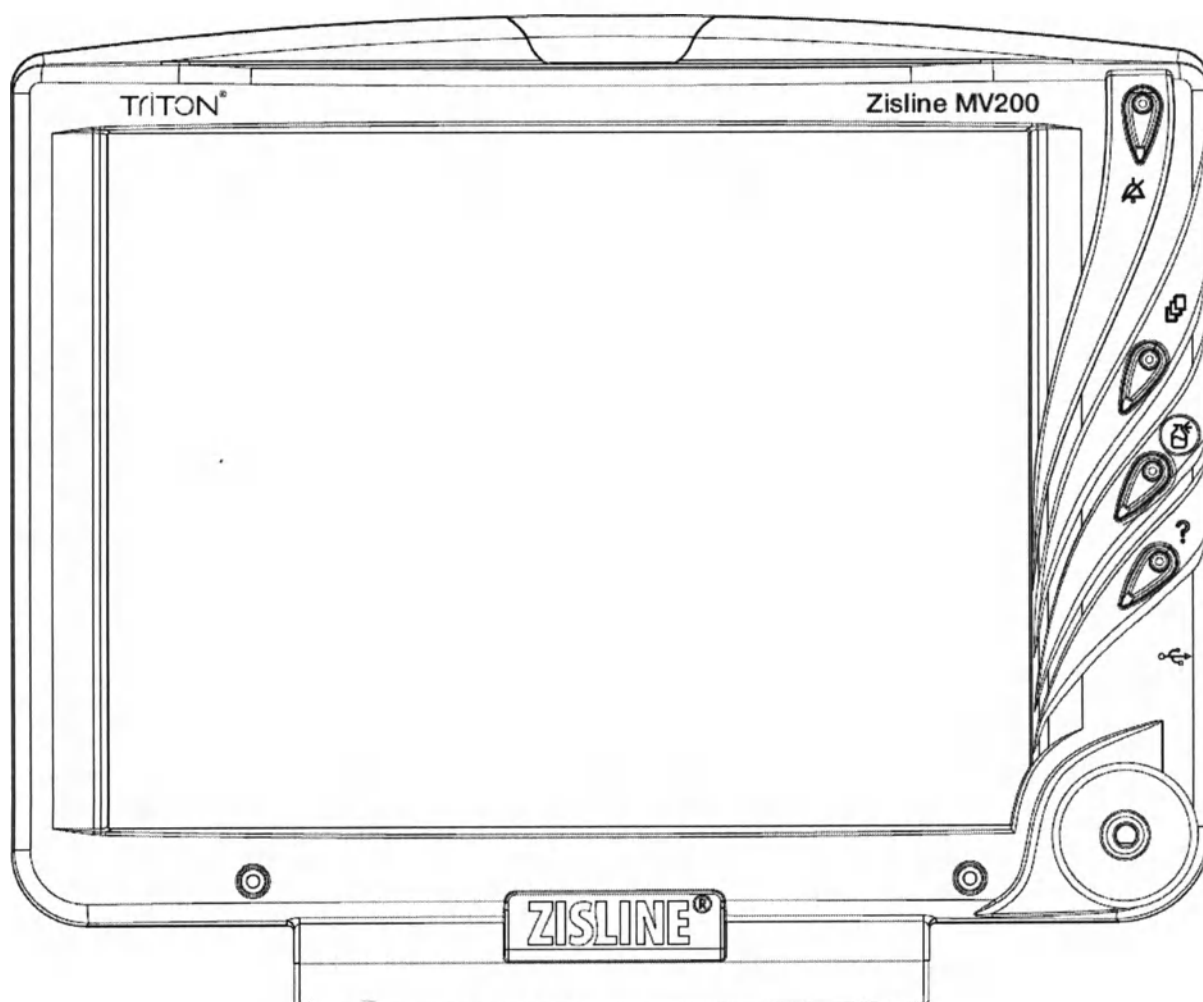


ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 9 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	--

Панель лицевая ТЭСМ.189614-01

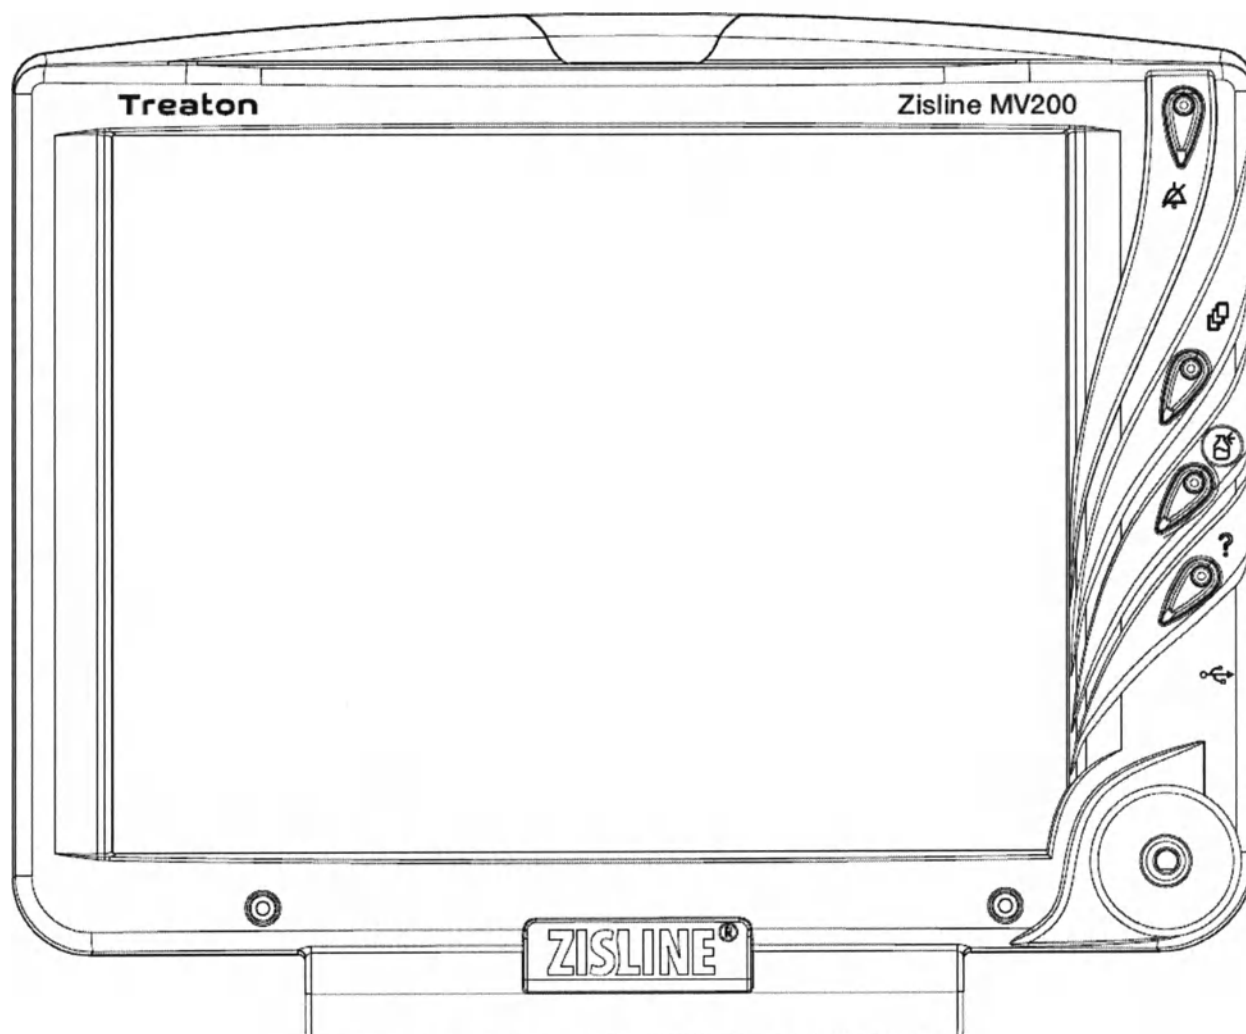


TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 10 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---


Панель лицевая ТЭСМ.239618-02

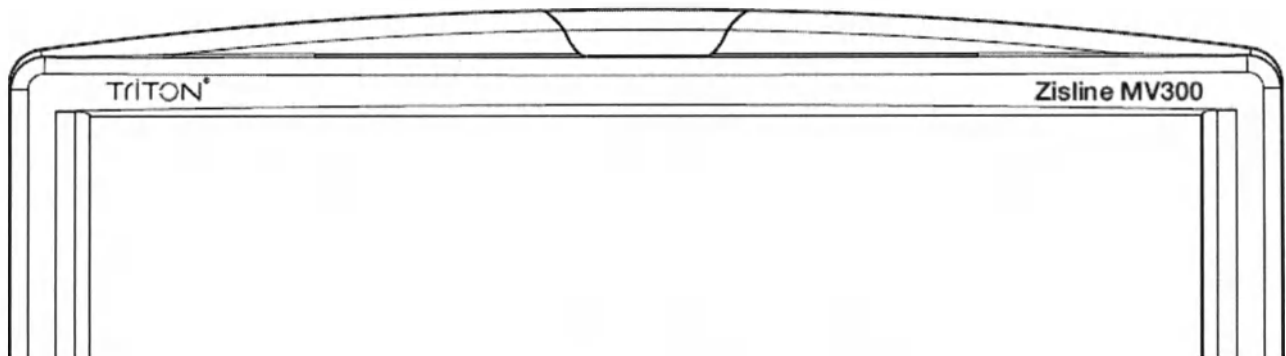


Панель лицевая ТЭСМ.239618-06

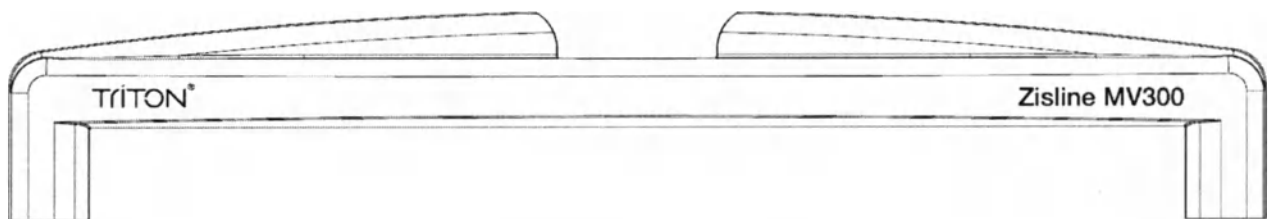

Панель лицевая ТЭСМ.239618-01

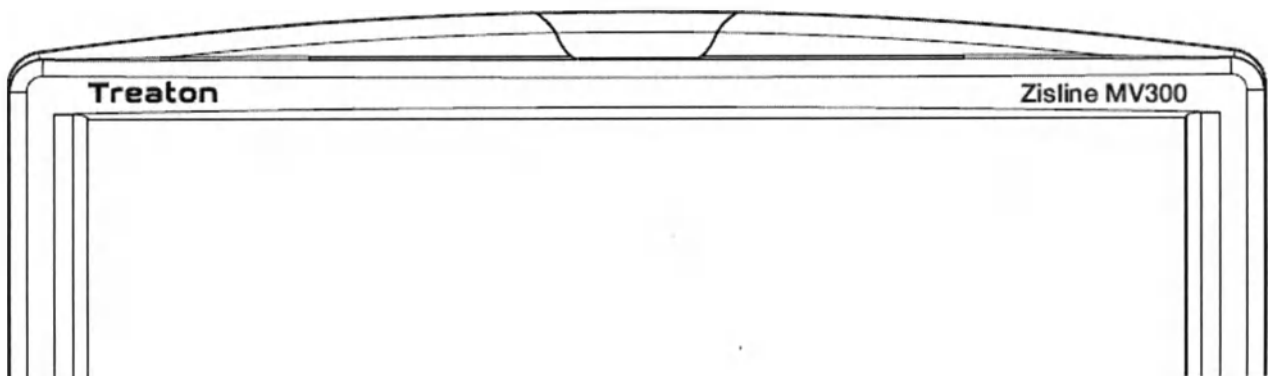


Панель лицевая ТЭСМ.239618-05

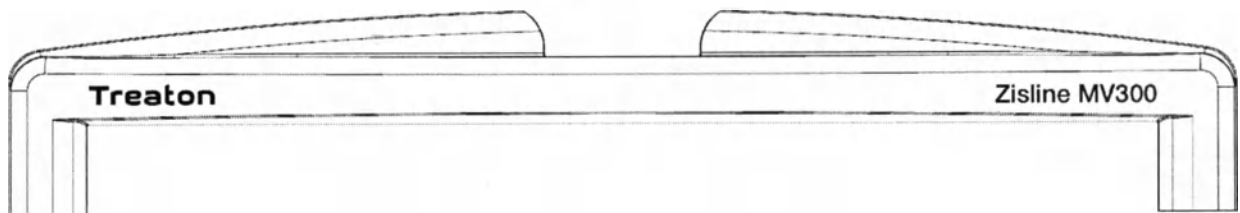


ТЭСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 11 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---


Панель лицевая ТЭСМ.239618-03

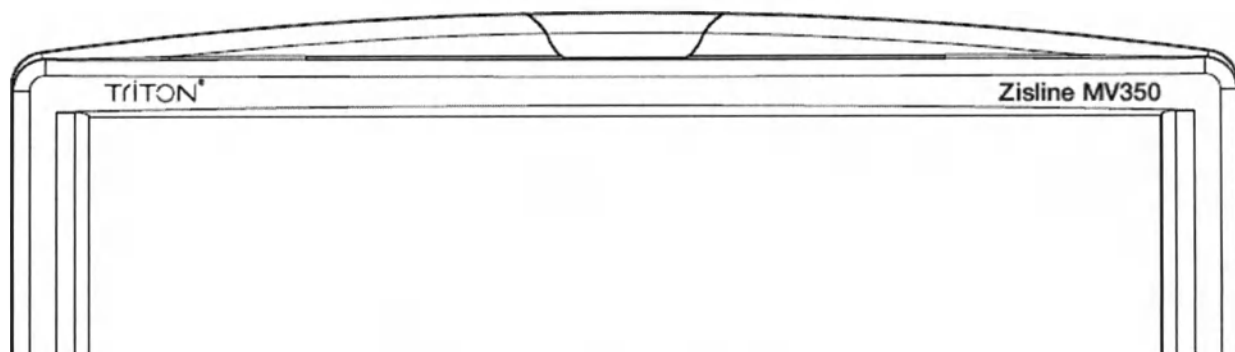


Панель лицевая ТЭСМ.239618-07

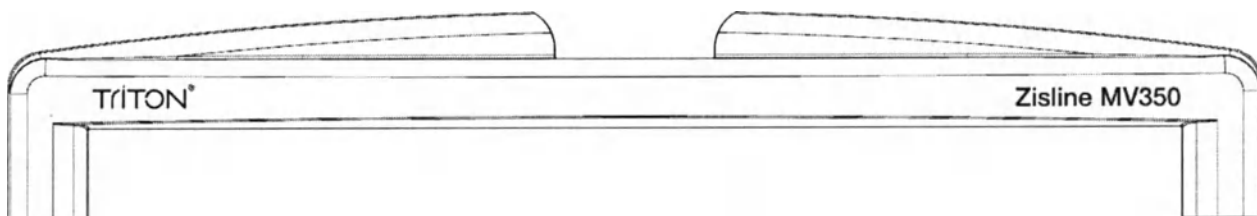

Панель лицевая ТЭСМ.239618-04

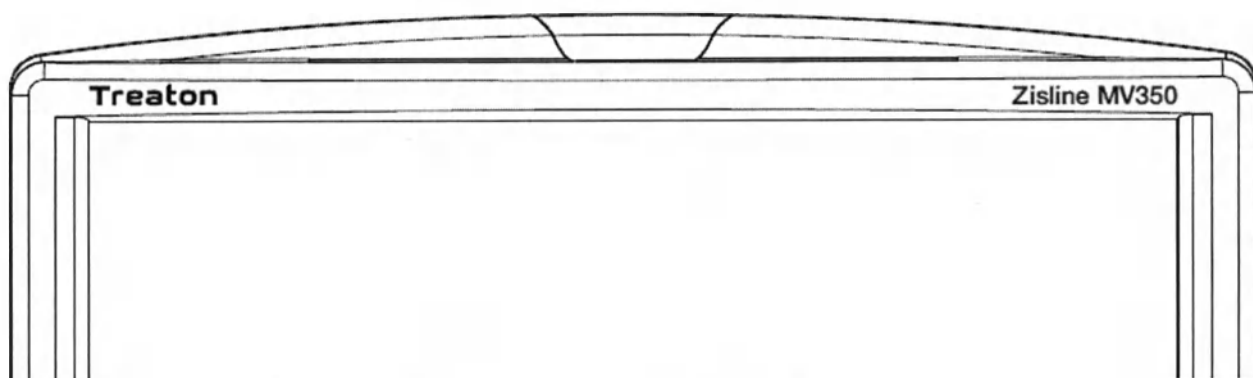

Панель лицевая ТЭСМ.239618-08

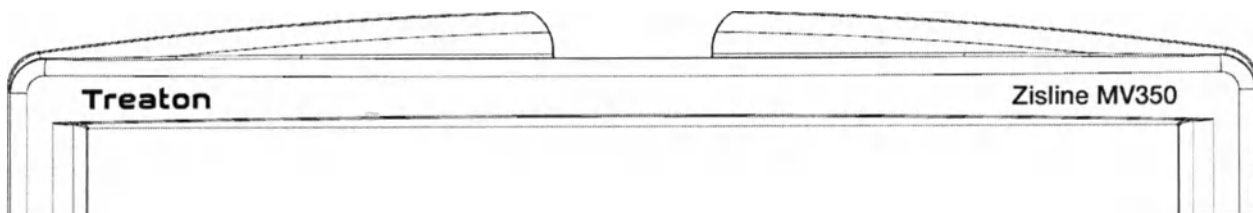

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 12 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

2 Маркировка составных частей аппарата

№ п/п	Наименование	Обозначение	
		Товарный знак Triton	Товарный знак Treaton
1	Наклейка на шланг кислородный (ТЭСМ.046002-01)	ТЭСМ.189944-08	ТЭСМ.189944-04
2	Наклейка на шланг кислородный (ТЭСМ.046002-02)	ТЭСМ.189944-02	ТЭСМ.189944-05
3	Наклейка «O2» (соединители кислородного шланга)	ТЭСМ.239917	ТЭСМ.239917-01
		ТЭСМ.239917-03	
4	Этикетка на фильтр-регулятор	TECH.239950-02	TECH.239950
5	Шильдик ДП (исполнение MV350)	ТЭСМ.239910	ТЭСМ.239910-01
6	Наклейка кабеля ДП (исполнение MV350)	ТЭСМ.239929	ТЭСМ.239929-02
7	Этикетка катетера	ТЭСМ.239924	ТЭСМ.239924-01
8	Наклейка тележки (ТЭСМ.186307-01)	ТЭСМ.189955	
9	Наклейка тележки (ТЭСМ.186307)	ТЭСМ.239920	
10	Наклейка «Внимание»	ТЭСМ.189953	
11	Наклейка «Не толкать»	ТЭСМ.239919	
12	Наклейка «Логотип»	ТЭСМ.189954	ТЭСМ.239911
13	Наклейка с наименованием (тележка транспортная ТЭСМ.186307)	ТЭСМ.239961	ТЭСМ.239961-01
14	Наклейка с наименованием (тележка транспортная ТЭСМ.186307-01)	ТЭСМ.239961-02	ТЭСМ.239961-03
15	Наклейка «Наименование КГП»	ТЭСМ.709905-11	ТЭСМ.709905-07
16	Маркировка логотип (модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы))	ТЭСМ.709902	ТЭСМ.709902-01
17	Этикетка (вентиляционный адаптер ТЭСМ.706020)	ТЭСМ.709000	ТЭСМ.709000-09
18	Этикетка (вентиляционный адаптер ТЭСМ.706021)	ТЭСМ.709001	ТЭСМ.709001-08
19	Наклейка (датчик пульсоксиметрический педиатрический, клипса)	ТЭСМ.539460-03	ТЭСМ.539460-17
20	Наклейка (переходник датчика пульсоксиметрического)	ТЭСМ.009425-27	ТЭСМ.009425-53
21	Наклейка «Дезинфекция»	ТЭСМ.709910	

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 13 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

№ п/п	Наименование	Обозначение	
		Товарный знак Triton	Товарный знак Treaton
22	Макет маркировки составных частей многоразового применения	-	
23	Макет маркировки составных частей одноразового применения	-	

Примечание – представлена маркировка на составные части собственного производства.

Маркировка медицинских изделий, имеющих РУ и входящих в состав аппарата, см. сайт Росздравнадзора <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>.

Общий макет маркировки на упаковке покупных изделий, не имеющих РУ и входящих в состав аппарата, см. п/п 22, 23. Информация с общего макета маркировки и(или) дополнительные символы могут быть выполнены разными способами на оригинальной маркировке.

Маркировка производителя на каждое покупное изделие не включена в данный документ, т.к.:

- покупные составные части приходят в оригинальной упаковке производителя и не переупаковываются;
- идентификация составных частей проверяется на входном контроле при приемке на склад;
- в руководство по эксплуатации на аппарат введена информация о значениях дополнительных символов маркировки, указанных на оригинальной упаковке покупных составных частей.

ТЭСМ.189944-08



ТЭСМ.189944-04



TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 14 из 40 Ревизия: 6
---------------------	--	---


ТЭСМ.189944-09




ТЭСМ.189944-05




ТЭСМ.239917



ТЭСМ.239917-01



ТЭСМ.239917-03



TECH.239950-02




TECH.239950



ТЭСМ.239910



ТЭСМ.239910-01



TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 15 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

ТЭСМ.239929



www.treaton.ru


 ООО фирма
 «Тритон-ЭлектроникС»
 Россия, 620133, г. Екатеринбург,
 ул. Бажова, 33

Кабель датчика
потока
ТЭСМ.236116

SN



ТЭСМ.239929-02



www.treaton.ru


 ООО фирма
 «Тритон-ЭлектроникС»
 Россия, 620133, г. Екатеринбург,
 ул. Бажова, 33

Кабель датчика
потока
ТЭСМ.236116

SN



ТЭСМ.239924



www.treaton.ru

Катетер

ТУ 32.50.13-036-32119398-2023

Длина 40 см






STERILE EO



LOT




 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
 Россия, 620133, г. Екатеринбург,
 ул. Бажова, 33



ТЭСМ.239924-01



www.treaton.ru

Катетер

ТУ 32.50.13-036-32119398-2023

Длина 40 см






STERILE EO




LOT





 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
 Россия, 620133, г. Екатеринбург,
 ул. Бажова, 33



ТЭСМ.189955

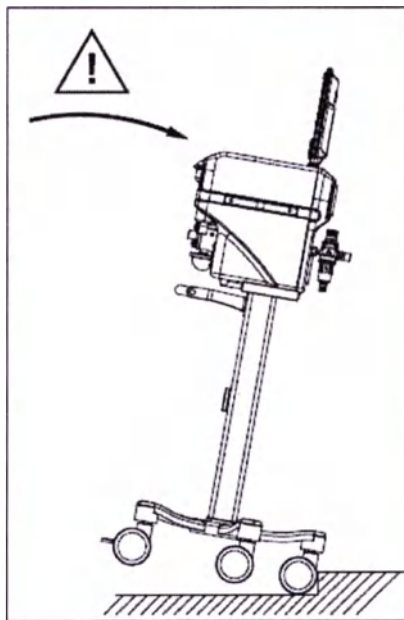

ТЭСМ.239920

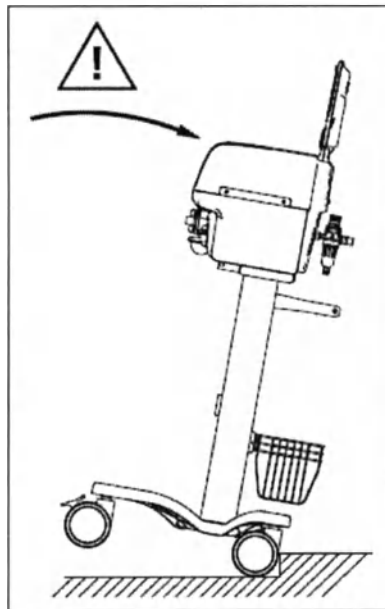

ТЭСМ.189953



Внимание Caution

При эксплуатации аппарат должен быть надежно зафиксирован на тележке в трех точках болтами и гайкой из комплекта поставки.

Опасность опрокидывания повышается в случае:

- установки или перемещения тележки на неровном полу;
- перемещения тележки через препятствия, такие как пороги;
- прислонения к тележке тяжелых предметов;
- крепления оборудования и принадлежностей за пределами центра тяжести.

Не опирайтесь и не прислоняйтесь к аппарату, установленному на тележке.

Для предотвращения опрокидывания при перемещении удерживайте ручку тележки обеими руками.

During operation the device should be securely fixed to the table of the cart in three points with supplied bolts and nut.

Increased tilting danger in case of:

- placing or moving the cart on sloped floors;
- pulling the cart over obstacles like doorsteps;
- heavy items leaning against the cart;
- equipment and accessories mounted outside the center of gravity.

Do not lean against the cart.

To prevent tipping over during cart moving hold the cart handle with both hands.



TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 17 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.189954

TRITON®

ТЭСМ.239911

Treaton

ТЭСМ.239961

ТЭСМ.239961-01

Тележка
транспортная
ТЭСМ.186307

TRITON®
www.treaton.ru

SN



 65кг
max нагрузка



 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

Тележка
транспортная
ТЭСМ.186307

Treaton
www.treaton.ru

SN



 65кг
max нагрузка



 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239961-02

ТЭСМ.239961-03

Тележка
транспортная
ТЭСМ.186307-01

TRITON®
www.treaton.ru

SN



 65кг
max нагрузка



 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

Тележка
транспортная
ТЭСМ.186307-01

Treaton
www.treaton.ru

SN



 65кг
max нагрузка



 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 18 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

ТЭСМ.709905-11

TRITON®
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP44

Модуль газоанализа
дыхательной смеси
(без отбора пробы)
ТЭСМ.506001, в составе:
Датчик CO₂ в прямом
потоке ТЭСМ.506138

SN



ТЭСМ.709905-07

Treaton
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP44

Модуль газоанализа
дыхательной смеси
(без отбора пробы)
ТЭСМ.506001, в составе:
Датчик CO₂ в прямом
потоке ТЭСМ.506138


SN



ТЭСМ.709902



ТЭСМ.709902-01

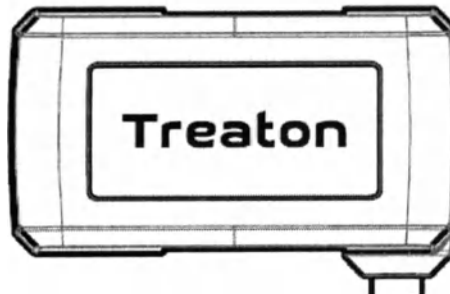


ТЭСМ.709000

TRITON®

Вентиляционный адаптер

Взрослый / детский
ТЭСМ.706020

LOT

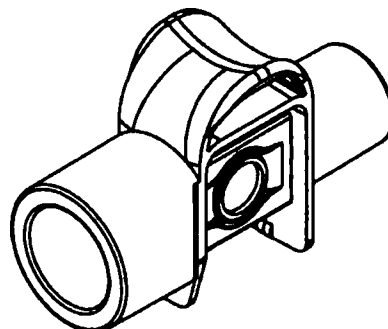

Адаптер предназначен для использования с Датчиком CO₂ в прямом потоке в составе Модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) (ТЭСМ.506001) производства ООО фирмы «Тритон-ЭлектроникС».

Внимание:

- Не используйте адаптеры, имеющие механические повреждения
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на окнах адаптера



ООО фирма

«Тритон-ЭлектроникС»

Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

Сервисная служба тел.:

+7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53

Эл. почта: mail@treaton.ru

Сайт: www.treaton.ru

Метод стерилизации:Автоклави-
рование134 °C,
0,21 МПа,
5 мин

Не менее 100 циклов стерилизации

ТЭСМ.709000-09


Treaton

Вентиляционный адаптер

Взрослый / детский
 ТЭСМ.706020



LOT

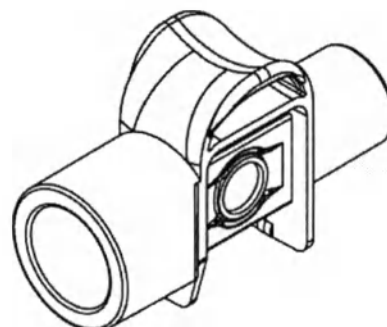

Адаптер предназначен для использования с Датчиком CO₂ в прямом потоке в составе Модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) (ТЭСМ.506001) производства ООО фирмы «Тритон-ЭлектроникС».

Внимание:

- Не используйте адаптеры, имеющие механические повреждения
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на окнах адаптера



ООО фирма

«Тритон-ЭлектроникС»

Россия, 620133, г. Екатеринбург,
 ул. Бажова, 33

Сервисная служба тел.:

+7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53

Эл. почта: mail@treaton.ru

Сайт: www.treaton.ru

Метод стерилизации:

Автоклави- рование	134 °C, 0,21 МПа, 5 мин
	Не менее 100 циклов стерилизации

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 21 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.709001

TRITON®


Вентиляционный адаптер

Детский / неонатальный

ТЭСМ.70602 1



LOT

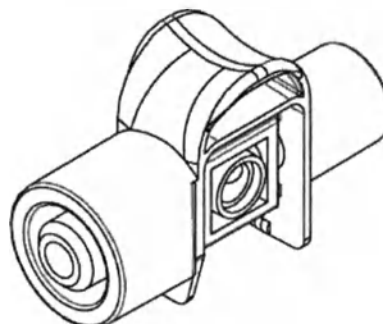

Адаптер предназначен для использования с Датчиком CO₂ в прямом потоке в составе Модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) (ТЭСМ.506001) производства ООО фирмы «Тритон-ЭлектроникС».

Внимание:

- Не используйте адаптеры, имеющие механические повреждения
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на окнах адаптера



ООО фирма

«Тритон-ЭлектроникС»

Россия, 620133, г. Екатеринбург,

ул. Бажова, 33

Сервисная служба тел.:

+7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53

Эл. почта: mail@treaton.ru

Сайт: www.treaton.ru

Метод стерилизации:

Автоклави-
рование

134°C,
0,21 МПа,
5 мин

Не менее 100 циклов стерилизации

ТЭСМ.709001-08

Treaton


Вентиляционный адаптер

Детский / неонатальный

ТЭСМ.70602 1



LOT

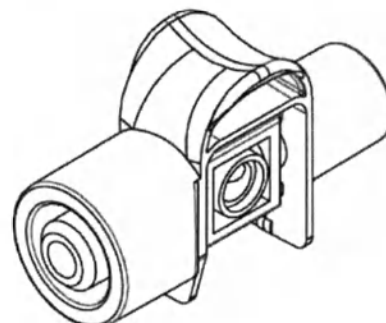

Адаптер предназначен для использования с Датчиком CO₂ в прямом потоке в составе Модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) (ТЭСМ.506001) производства ООО фирмы «Тритон-ЭлектроникС».

Внимание:

- Не используйте адаптеры, имеющие механические повреждения
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на окнах адаптера

**ООО фирма****«Тритон-ЭлектроникС»**

Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

Сервисная служба тел.:

+7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53

Эл. почта: mail@treaton.ru

Сайт: www.treaton.ru

Метод стерилизации:

Автоклави-
рование

134°C,
0,21 МПа,
5 мин

Не менее 100 циклов стерилизации

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 23 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.539460-03

TRITON[®]
www.treaton.ru

Датчик
пульсоксиметрический
педиатрический, клипса
ТЭСМ.096011

 IP22





ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.539460-17

Treaton
www.treaton.ru

Датчик
пульсоксиметрический
педиатрический, клипса
ТЭСМ.096011

 IP22





ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.009425-27

TRITON[®]
www.treaton.ru

Переходник датчика
пульсоксиметрического
ТЭСМ.534014-01





ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.009425-53

Treaton
www.treaton.ru

Переходник датчика
пульсоксиметрического
ТЭСМ.534014-01





ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.709910




Дезинфицируйте
протираием!




Не погружайте
в жидкость!
Не растягивайте кабель
при дезинфекции!

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 24 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

Макет маркировки составных частей многоразового применения (п/п 22)

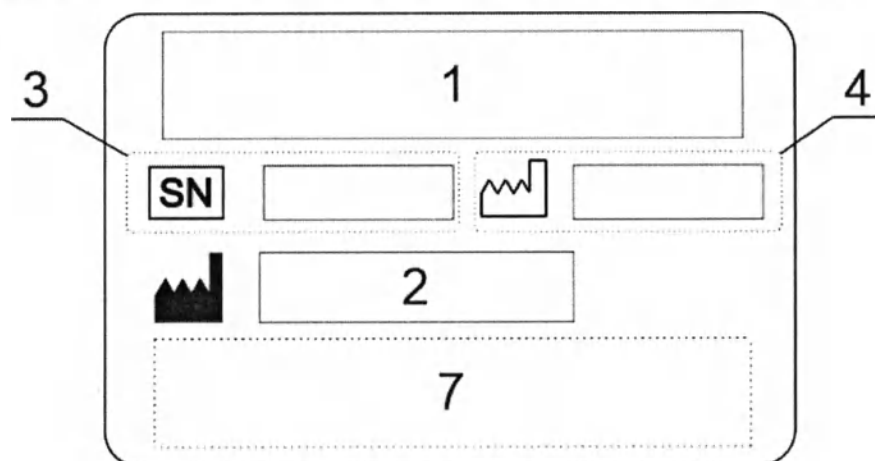

Макет маркировки составных частей одноразового применения (п/п 23)

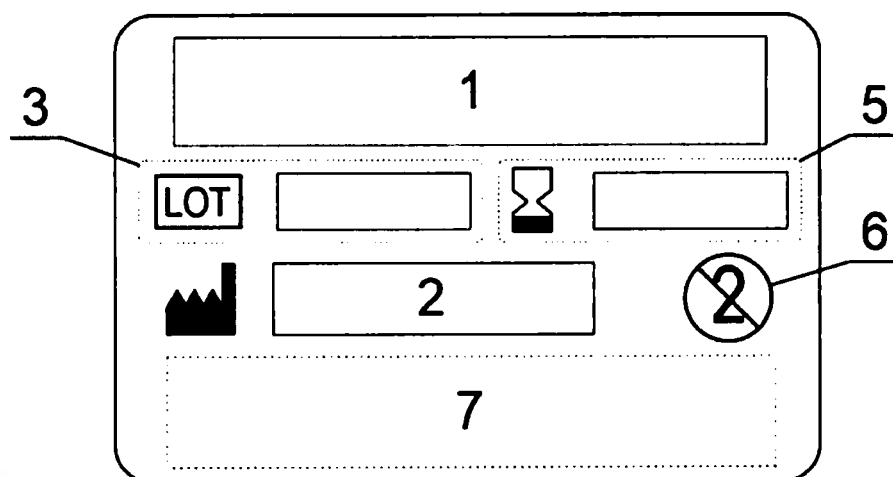

- 1 – наименование и (или) обозначение (артикул/номер по каталогу);
- 2 – наименование и (или) товарный знак производителя;
- 3 – заводской (серийный) номер или код партии;
- 4 – дата изготовления;
- 5 – дата изготовления или дата, после истечения которой изделие не должно использоваться;
- 6 – запрет на повторное применение.
- 7 (взамен 3-5) – указание о наличии дополнительной информации на основной маркировке, например, «Серийный номер / номер партии, дата изготовления / дата, после истечения которой изделие не должно использоваться, дополнительные символы– см. основную маркировку».

 - постоянные данные;

 - переменные данные.

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 25 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

3 Транспортная маркировка

№ п/п	Наименование	Обозначение	
		Товарный знак	
		Triton	Treaton
1	Этикетка на коробку	TECH.239959	TECH.239959-02
2	Этикетка с наименованием	ТЭСМ.239906	ТЭСМ.239906-02
3	Этикетка транспортная (коробка с электронным блоком)	ТЭСМ.239909	
4	Этикетка транспортная (ящик)	ТЭСМ.239909-01, -02	
5	Наклейка «Манипуляционные знаки» (для коробки с электронным блоком)	ТЭСМ.189957	
6	Манипуляционные знаки (на ящик по трафарету)	-	
7	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096021)	TECH.009433*	
8	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096021-01)	TECH.009433-03*	
9	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096022)	TECH.009433-01*	
10	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096022-01)	TECH.009433-04*	
11	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096027)	TECH.009433-02*	
12	Наклейка одноразового датчика SpO2 (TECH.096027-01)	TECH.009433-05*	
13	Этикетка (для потребительской упаковки составных частей)	ТЭСМ.239932, -01...-13	TECH.239942, -01...-13
14	Этикетка	TECH.239947,-01...-04	
* - товарный знак определяется при заказе			

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 26 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

TECH.239959

TRITON®			
		ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33	
Наименование или обозначение типа изделия:		Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350 ТУ 32.50.21-020-32119398-2020	
Исполнение:	MV200		
	MV300		
	MV350		
SN			
РУ		№ РЗН 2015/2814	
Год и месяц упаковывания:			
Сервисная служба:		тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53	
Служба качества:		тел.: +7 (343) 304-60-50	

TECH.239959-02

Treaton			
		ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33	
Наименование или обозначение типа изделия:		Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350 ТУ 32.50.21-020-32119398-2020	
Исполнение:	MV200		
	MV300		
	MV350		
SN			
РУ		№ РЗН 2015/2814	
Год и месяц упаковывания:			
Сервисная служба:		тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53	
Служба качества:		тел.: +7 (343) 304-60-50	

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 27 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.239906


TRITON®			
		ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33	
Юридический адрес:		Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9-217	
Наименование или обозначение изделия:		Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350 ТУ 32.50.21-020-32119398-2020	
Исполнение:	MV200		
	MV300		
	MV350		
SN			
РУ		№ РЗН 2015/2814	
№ места / кол-во мест:			
Год и месяц упаковывания:			
Сервисная служба		тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53	
Служба качества		тел.: +7 (343) 304-60-50	
Эл. почта		mail@treaton.ru	
Сайт		www.treaton.ru	

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 28 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.239906-02


Treaton			
		ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33	
Юридический адрес:		Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9-217	
Наименование или обозначение изделия:		Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350 ТУ 32.50.21-020-32119398-2020	
Исполнение:	MV200		
	MV300		
	MV350		
SN			
РУ		№ РЗН 2015/2814	
№ места / кол-во мест:			
Год и месяц упаковывания:			
Сервисная служба		тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53	
Служба качества		тел.: +7 (343) 304-60-50	
Эл. почта		mail@treaton.ru	
Сайт		www.treaton.ru	

ТЭСМ.239909

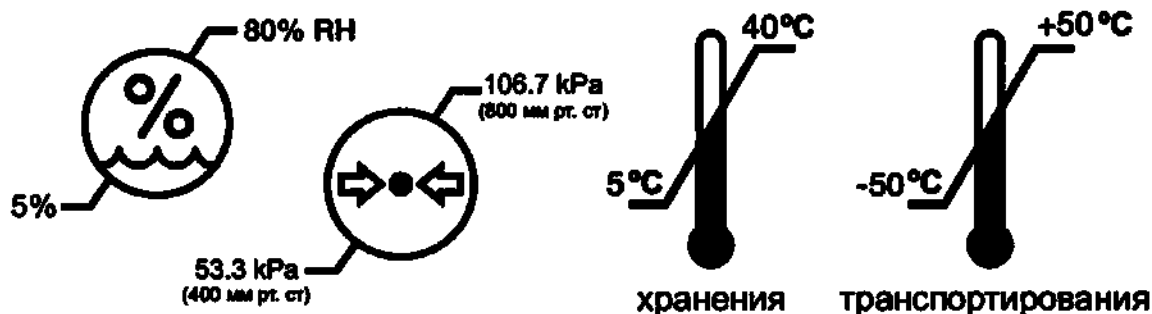БРУТТО
НЕТТО**23 кг**
21 кг

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

ТЭСМ.239909-01

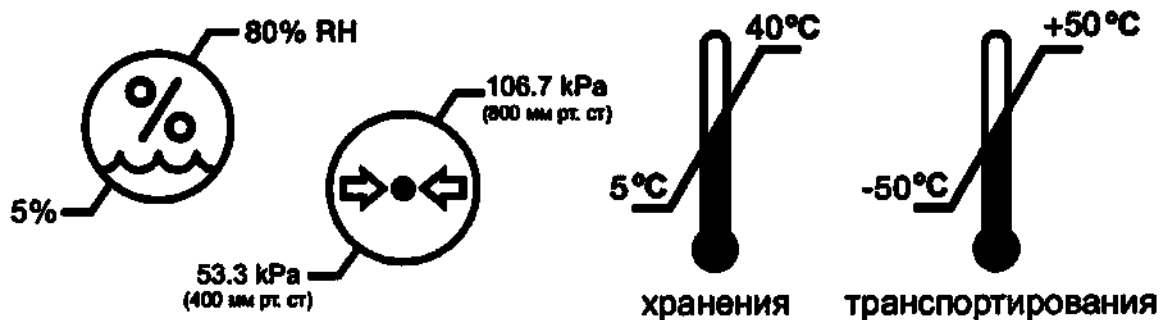БРУТТО
НЕТТО**52 кг**
40 кг

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Допустимый предел при хранении - 5 ярусов

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 30 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

ТЭСМ.239909-02

БРУТТО

НЕТТО

КГ

КГ




80% RH

5%



106.7 kPa
(800 мм рт. ст.)


53.3 kPa
(400 мм рт. ст.)



40°C

5°C

хранения




+50°C

-50°C

транспортирования


Гарантийный срок хранения - 6 месяцев
Допустимый предел при хранении - 5 ярусов

ТЭСМ.189957

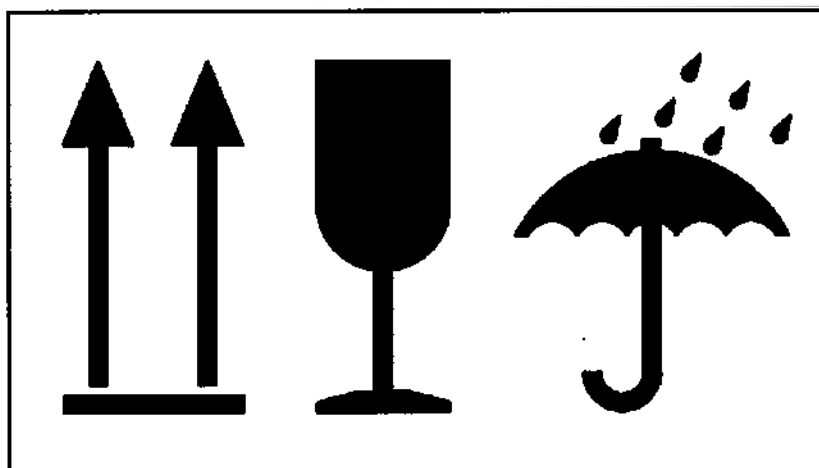

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 31 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

Манипуляционные знаки

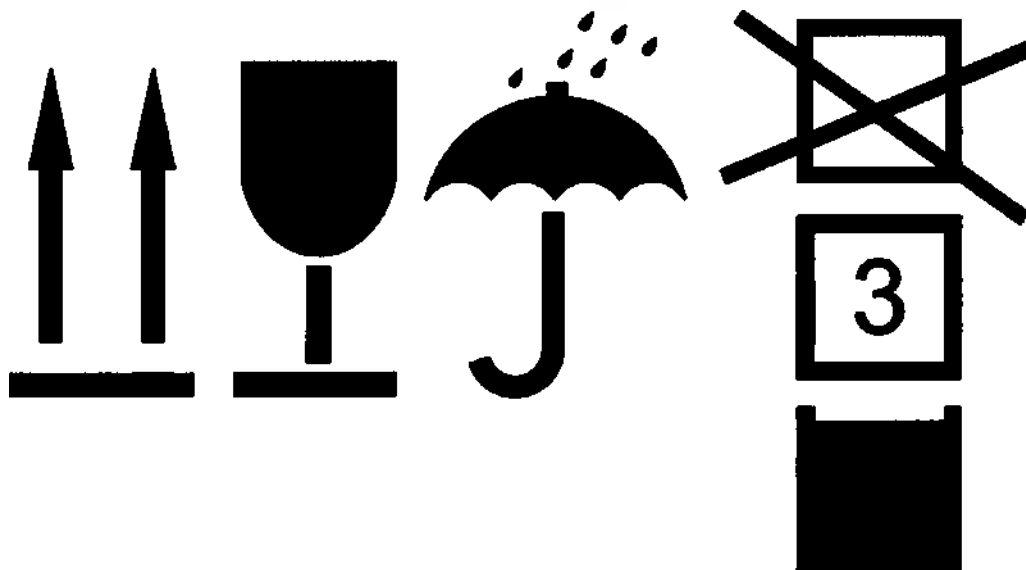

TECH.009433*

TRITON®
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
детский, самоклеящийся
TECH.096021

3 - 20 кг

IP22

LOT

Icons: factory, hourglass, and safety symbols (flame, exclamation mark, non-storable, no open flame, no smoking).

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
детский, самоклеящийся
TECH.096021

3 - 20 кг

IP22

LOT

Icons: factory, hourglass, and safety symbols (flame, exclamation mark, non-storable, no open flame, no smoking).

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.009433-03*

TRITON®
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
детский, самоклеящийся
TECH.096021-01

3 - 20 кг

IP22

LOT

Icons: factory, hourglass, and safety symbols (flame, exclamation mark, non-storable, no open flame, no smoking).

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
детский, самоклеящийся
TECH.096021-01

3 - 20 кг

IP22

LOT

Icons: factory, hourglass, and safety symbols (flame, exclamation mark, non-storable, no open flame, no smoking).

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 32 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

TECH.009433-01*

TRITON[®]
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, самоклеющийся
TECH.096022



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, самоклеющийся
TECH.096022



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.009433-04*

TRITON[®]
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, самоклеющийся
TECH.096022-01



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, самоклеющийся
TECH.096022-01



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.009433-02*

TRITON[®]
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, текстильная застежка
TECH.096027



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, текстильная застежка
TECH.096027



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT



IP22     

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 33 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

TECH.009433-05*

TRITON®
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, текстильная застежка
TECH.096027-01



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT

IP22



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

ТЭСМ.239932

Treaton
Датчик пульсоксиметрический одноразовый,
взрослый/неонатальный, текстильная застежка
TECH.096027-01



> 10 кг 3 - 20 кг < 3 кг

LOT

IP22



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
www.treaton.ru

TECH.239942

TRITON®
www.treaton.ru
Шланг кислородный
ТЭСМ.046002-01

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-01

Treaton
www.treaton.ru
Шланг кислородный
ТЭСМ.046002-01

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-01

TRITON®
www.treaton.ru
Шланг кислородный
ТЭСМ.046002-02

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-02

Treaton
www.treaton.ru
Шланг кислородный
ТЭСМ.046002-02

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-02

TRITON®
www.treaton.ru
Фильтр-регулятор
ТЭСМ.186143

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Treaton
www.treaton.ru
Фильтр-регулятор
ТЭСМ.186143

SN



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 34 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.239932-03

TRITON®
www.treaton.ru

Тележка транспортная
ТЭСМ.186307

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-03

Treaton
www.treaton.ru

Тележка транспортная
ТЭСМ.186307

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-04

TRITON®
www.treaton.ru

Тележка транспортная
ТЭСМ.186307-01

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-04

Treaton
www.treaton.ru

Тележка транспортная
ТЭСМ.186307-01

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-05

TRITON®
www.treaton.ru

**Трубка подключения к кислородному
концентратору**
TECH.233008

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-05

Treaton
www.treaton.ru

**Трубка подключения к кислородному
концентратору**
TECH.233008

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-06

TRITON®
www.treaton.ru

**Модуль газоанализа дыхательной смеси
(без отбора пробы)**
ТЭСМ.506001

В составе:
- датчик CO₂ в прямом потоке – 1шт.;
- вентиляционный адаптер взрослый/детский – 1шт.;
- вентиляционный адаптер детский/неонатальный – 1шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239942-06

Treaton
www.treaton.ru

**Модуль газоанализа дыхательной смеси
(без отбора пробы)**
ТЭСМ.506001

В составе:
- датчик CO₂ в прямом потоке – 1шт.;
- вентиляционный адаптер взрослый/детский – 1шт.;
- вентиляционный адаптер детский/неонатальный – 1шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 35 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

ТЭСМ.239932-07

TECH.239942-07

TRITON®
www.treaton.ru

Модуль потока внешний
ТЭСМ.236001

В составе:

- кабель датчика потока – 1шт.;
- датчик потока многоразовый – до 2шт.;
- датчик потока однократный – до 5шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Treaton
www.treaton.ru

Модуль потока внешний
ТЭСМ.236001

В составе:

- кабель датчика потока – 1шт.;
- датчик потока многоразовый – до 2шт.;
- датчик потока однократный – до 5шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-08

TECH.239942-08

Комплект дыхательного контура многоразовый
TECH.233015

TRITON®
www.treaton.ru

В составе: Трубки гофрированные силиконовые для дыхательных аппаратов ТГСД по ТУ 9444-016-48423543-2007 (ПУ № ФСР 2008/03244) – до 5шт.; влагосборник – до 2шт.; пилбей нагреватель (опционально) – 1шт.; кабель питания (опционально) – 1шт.; адаптер (опционально) – 1шт.; струна (опционально) – 1шт.; устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии (ПУ №ФСЗ 2009/03551), в составе: соединитель с портами, без линей мониторинга: жесткий; Y-образный – 1шт.; соединитель без портов и линей мониторинга: жесткий; прямой – до 2шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Комплект дыхательного контура многоразовый
TECH.233015

Treaton
www.treaton.ru

В составе: Трубки гофрированные силиконовые для дыхательных аппаратов ТГСД по ТУ 9444-016-48423543-2007 (ПУ № ФСР 2008/03244) – до 5шт.; влагосборник – до 2шт.; пилбей нагреватель (опционально) – 1шт.; кабель питания (опционально) – 1шт.; адаптер (опционально) – 1шт.; струна (опционально) – 1шт.; устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии (ПУ №ФСЗ 2009/03551), в составе: соединитель с портами, без линей мониторинга: жесткий; Y-образный – 1шт.; соединитель без портов и линей мониторинга: жесткий; прямой – до 2шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-09

TECH.239942-09

Набор для nIMV
TECH.233012

TRITON®
www.treaton.ru

В составе: Генератор nCPAP Miniflow® однократный – до 5шт.; маски однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; канюли однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; шапочки однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках (ПУ № ФСЗ 2011/09111), в составе: RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290 – до 5шт. или RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока – до 5шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Набор для nIMV
TECH.233012

Treaton
www.treaton.ru

В составе: Генератор nCPAP Miniflow® однократный – до 5шт.; маски однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; канюли однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; шапочки однократные: размер S – до 5шт, размер M – до 5шт, размер L – до 5шт; изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках (ПУ № ФСЗ 2011/09111), в составе: RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290 – до 5шт. или RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока – до 5шт.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 36 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

ТЭСМ.239932-10

TECH.239942-10

Набор для nCPAP Medin
TECH.233013

TRITON®
www.treaton.ru

в составе: Генератор nCPAP Medijet® одноразовый - до 5шт; маски одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; канюли одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; шапочки одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках (ПУ № ФСЗ 2011/09111), в составе: RT224 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290 - до 5шт. или RT124 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Набор для nCPAP Medin
TECH.233013

Treaton
www.treaton.ru

в составе: Генератор nCPAP Medijet® одноразовый - до 5шт; маски одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; канюли одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; шапочки одноразовые: размер S - до 5шт, размер M - до 5шт, размер L - до 5шт; изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках (ПУ № ФСЗ 2011/09111), в составе: RT224 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290 - до 5шт. или RT124 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-11

TECH.239942-11

Набор для nCPAP
TECH.233014

TRITON®
www.treaton.ru

в составе: Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии (ПУ №ФСЗ 2009/03551), в составе: дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом с принадлежностями: шланг дыхательный (1шт.), генератор потока, линия мониторинга - до 5 шт.; назальные канюли для новорожденных с прямыми зубцами; для назального CPAP размерами: S (малый) - до 5шт., M (средний) - до 5шт., L (большой) - до 5шт.; маски для вентиляции легких для новорожденных, размерами: S (малый) - до 5шт., M (средний) - до 5шт., L (большой) - до 5шт., XL (экстремально большой) - до 5шт.; маски для CPAP; держатели-фиксаторы: для шлангов и трубок - шапочка: размер 7 - до 5шт.; размер 3 - до 5шт.; размер 000 - до 5шт.; соединитель: жесткий, прямой - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Набор для nCPAP
TECH.233014

Treaton
www.treaton.ru

в составе: Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии (ПУ №ФСЗ 2009/03551), в составе: дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом с принадлежностями: шланг дыхательный (1шт.), генератор потока, линия мониторинга - до 5 шт.; назальные канюли для новорожденных с прямыми зубцами; для назального CPAP размерами: S (малый) - до 5шт., M (средний) - до 5шт., L (большой) - до 5шт.; маски для вентиляции легких для новорожденных, размерами: S (малый) - до 5шт., M (средний) - до 5шт., L (большой) - до 5шт., XL (экстремально большой) - до 5шт.; маски для CPAP; держатели-фиксаторы: для шлангов и трубок - шапочка: размер 7 - до 5шт.; размер 3 - до 5шт.; размер 000 - до 5шт.; соединитель: жесткий, прямой - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

ТЭСМ.239932-12

TECH.239942-12

Набор для nCPAP
TECH.233014-01

TRITON®
www.treaton.ru

в составе: Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных (ПУ № ФСЗ 2011/10229): дыхательный контур пациента, вариант исполнения: дыхательный контур пациента с генератором дыхания - до 5шт.; канюли назальные: размер S - до 5шт.; размер M - до 5шт.; размер L - до 5шт.; маски лицевые дыхательные: размер S - до 5шт.; размер M - до 5шт.; размер L - до 5шт.; размер XL - до 5шт.; шапочки-фиксаторы дыхательные: размер 8 - до 5шт.; размер 4 - до 5шт.; размер 00 - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

Набор для nCPAP
TECH.233014-01

Treaton
www.treaton.ru

в составе: Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных (ПУ № ФСЗ 2011/10229): дыхательный контур пациента, вариант исполнения: дыхательный контур пациента с генератором дыхания - до 5шт.; канюли назальные: размер S - до 5шт.; размер M - до 5шт.; размер L - до 5шт.; маски лицевые дыхательные: размер S - до 5шт.; размер M - до 5шт.; размер L - до 5шт.; размер XL - до 5шт.; шапочки-фиксаторы дыхательные: размер 8 - до 5шт.; размер 4 - до 5шт.; размер 00 - до 5шт.

 ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 37 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	---

ТЭСМ.239932-13

TRITON®
www.treaton.ru

**Комплект дополнительного оборудования
ТЭСМ.233006**

В составе:

- клапан выдоха ТЭСМ.236115 – 1шт.;
- влагосборник ТЭСМ.239626 – до 2шт.;
- предохранитель ВПТ6-10-2А – 2шт.;
- фильтрующий элемент С104-F21/1-ОХ1 – 1шт.;
- мембрана ТЭСМ.236501 – до 2шт.;
- фильтр пылевой ТЭСМ.009926 – 2шт.;
- кольцо ТЭСМ.049124 – 2шт.






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH 239942-13

Treaton
www.treaton.ru

**Комплект дополнительного оборудования
ТЭСМ.233006**

В составе:

- клапан выдоха ТЭСМ.236115 – 1шт.;
- влагосборник ТЭСМ.239626 – до 2шт.;
- предохранитель ВПТ6-10-2А – 2шт.;
- фильтрующий элемент С104-F21/1-ОХ1 – 1шт.;
- мембрана ТЭСМ.236501 – до 2шт.;
- фильтр пылевой ТЭСМ.009926 – 2шт.;
- кольцо ТЭСМ.049124 – 2шт.






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33

TECH.239947

Клапан выдоха ТЭСМ.236115
(из комплекта дополнительного оборудования
ТЭСМ.233006)






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

TECH.239947-01

Влагосборник ТЭСМ.189626
(из комплекта дополнительного оборудования
ТЭСМ.233006)






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

TECH.239947-02

**Мембрана
ТЭСМ.236501**






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

TECH.239947-03

**Фильтр пылевой
ТЭСМ.009926**






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

TECH.239947-04

**Кольцо
ТЭСМ.049124**






ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 38 из 40 Ревизия: 6
---------------------	--	---

4 Упаковка

Упаковка электронного блока и составных частей в коробку ТЭСМ.186408 осуществляется в соответствии с упаковочным чертежом ТЭСМ.941144.001 УЧ (см. Приложение А).

Упаковка аппарата для транспортирования осуществляется в ящик деревянный ТЭСМ.236134 в соответствии с упаковочным чертежом ТЭСМ.941144.001 УЧ1 (см. Приложение А).

Упаковка дополнительных составных частей для транспортирования (при необходимости) осуществляется в ящик деревянный ТЭСМ.236134 в соответствии с упаковочным чертежом ТЭСМ.941144.001 УЧ2 (см. Приложение А).

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 39 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------

Приложение А

Перечень ссылочной конструкторской документации на упаковку аппарата искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350


Наименование упаковки	Обозначение	Производитель	Обозначение и тип конструкторского документа
Упаковка прибора в коробку	ТЕСН.236159	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЭСМ.941144.001 УЧ Упаковочный чертёж ТЕСН.236159 Упаковка прибора в коробку. Спецификация
Упаковка транспортная	ТЭСМ.233003 ¹⁾ или ТЭСМ.233003-01 ²⁾	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЭСМ.941144.001 УЧ1 Упаковочный чертёж ТЭСМ.233003 Упаковка транспортная. Спецификация
Упаковка транспортная	ТЭСМ.233007	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЭСМ.941144.001 УЧ2 Упаковочный чертёж ТЭСМ.233007 Упаковка транспортная. Спецификация
Примечания: 1) Для транспортной тележки ТЭСМ.186307; 2) Для транспортной тележки ТЭСМ.186307-01.			

ТЕСН.941144.001 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300, MV350	Страница: 40 из 40 Ревизия: 6
---------------------	---	----------------------------------


Лист учета изменений

№ ревизии	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений
4	14.06.2023	Введено обозначение документа и изменено его наименование. Изменен адрес производителя. Изменен метод нанесения маркировки с информацией о предохранителях и дополнительном входе O ₂ . Добавлен раздел с описанием упаковки и приложение А. Добавлен лист учета изменений.
5	25.12.2023	Маркировка изменена в связи с заменой или исключением из комплекта поставки аппарата некоторых импортных составных частей (например, пульсоксиметрических датчиков Masimo) из-за санкционных ограничений. Добавлен товарный знак Treaton. Изменены сайт и электронная почта производителя. Уточнена информация об условиях транспортирования и хранения. Введен макет маркировки покупных составных частей.
6	09.08.2024	В наклейке с наименованием тележки транспортной добавлено обозначение безопасной рабочей нагрузки


сентябрь 2024г.

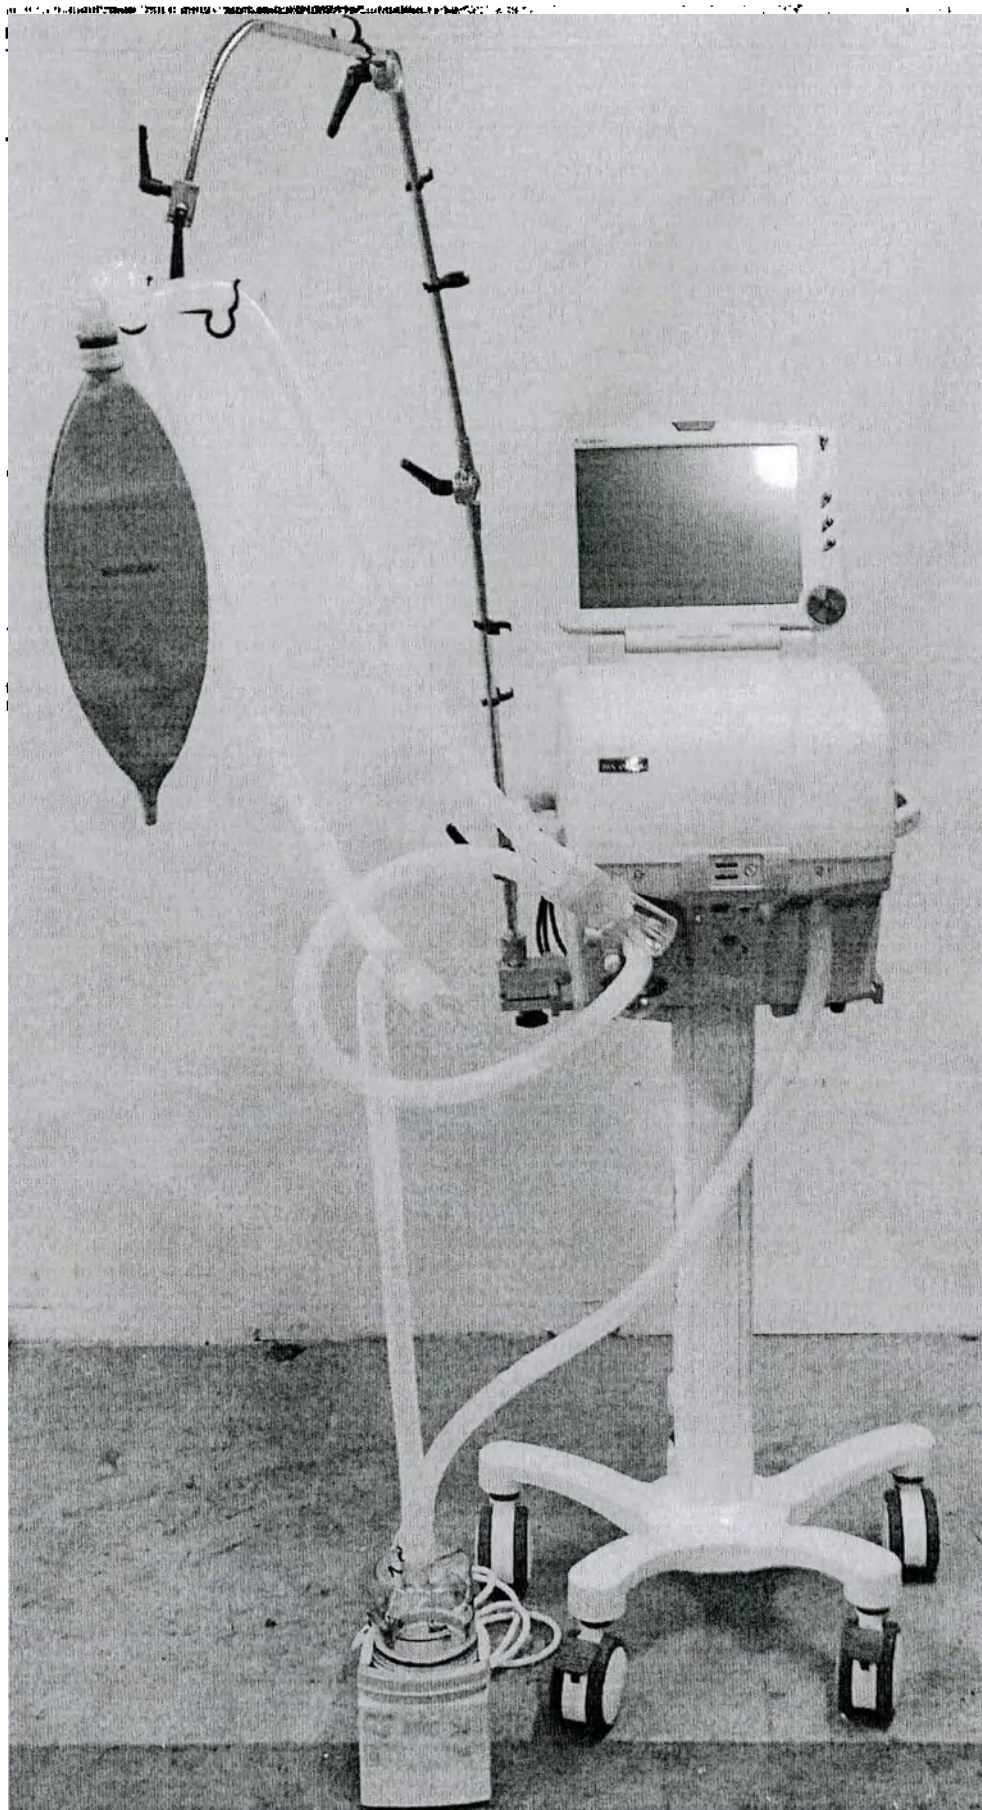

1 Электронный блок, ТЭСМ.230001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

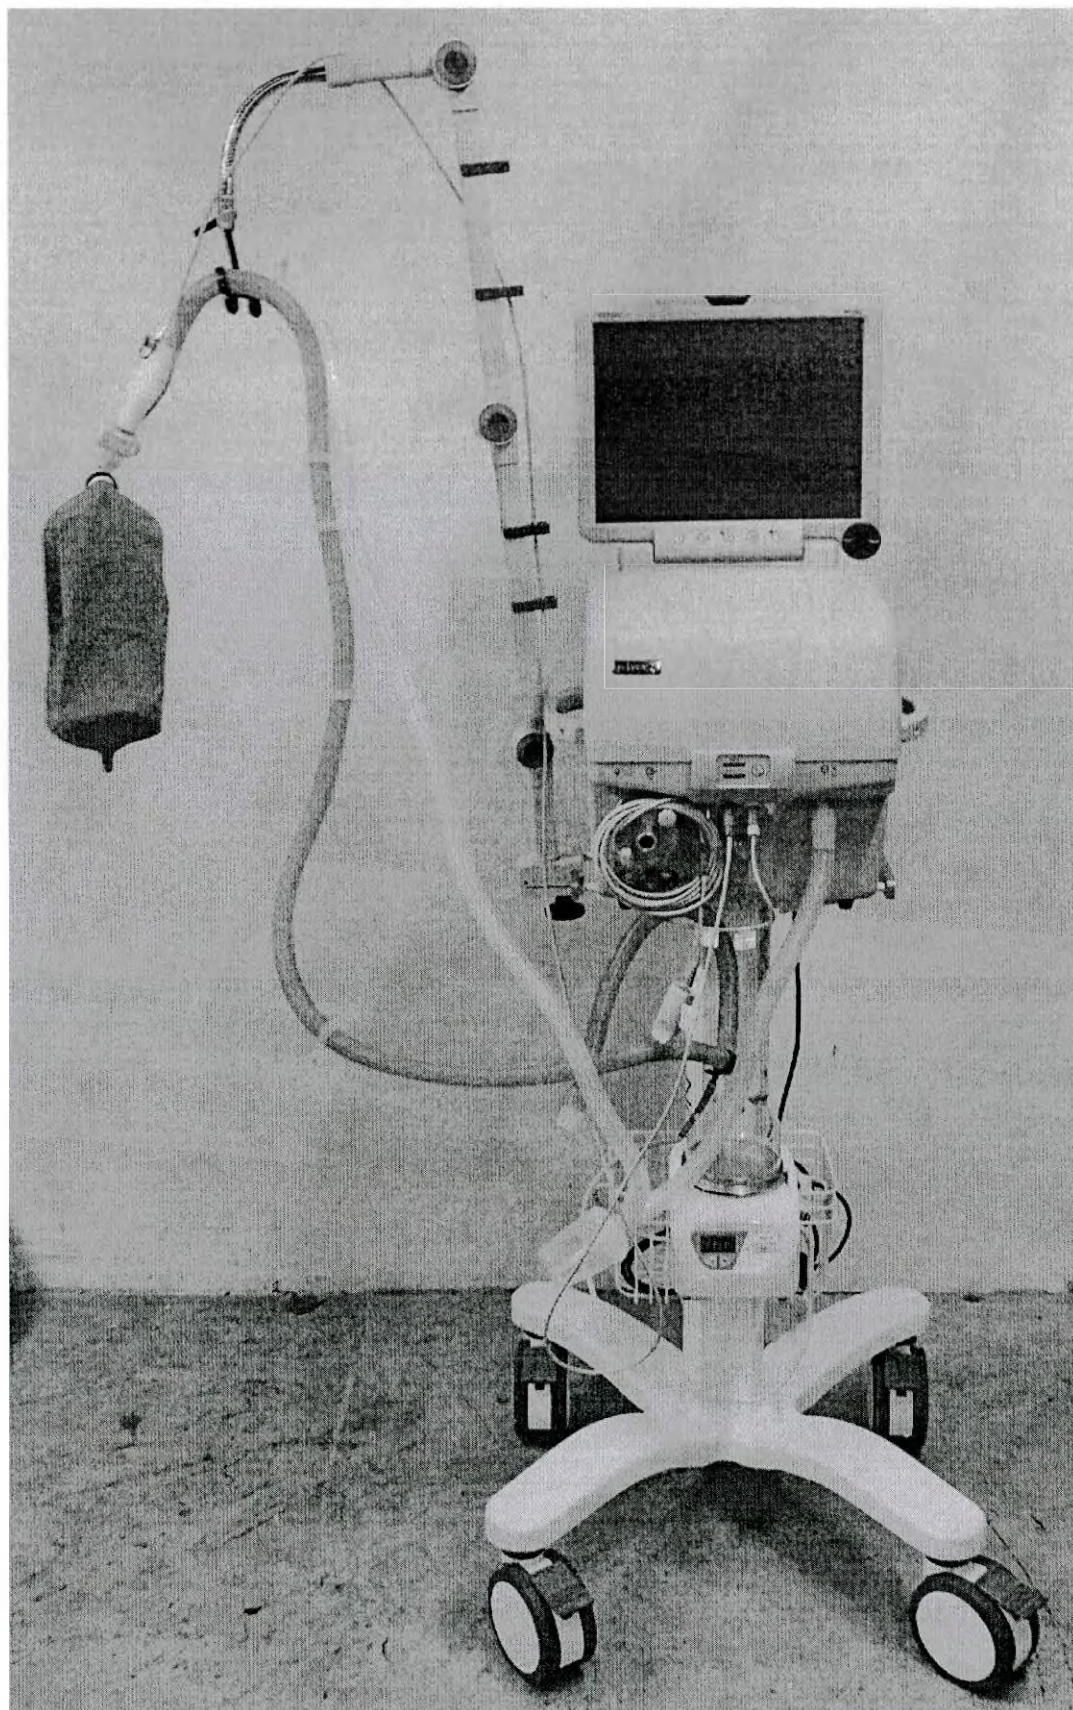


1 Электронный блок, ТЭСМ.230002, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

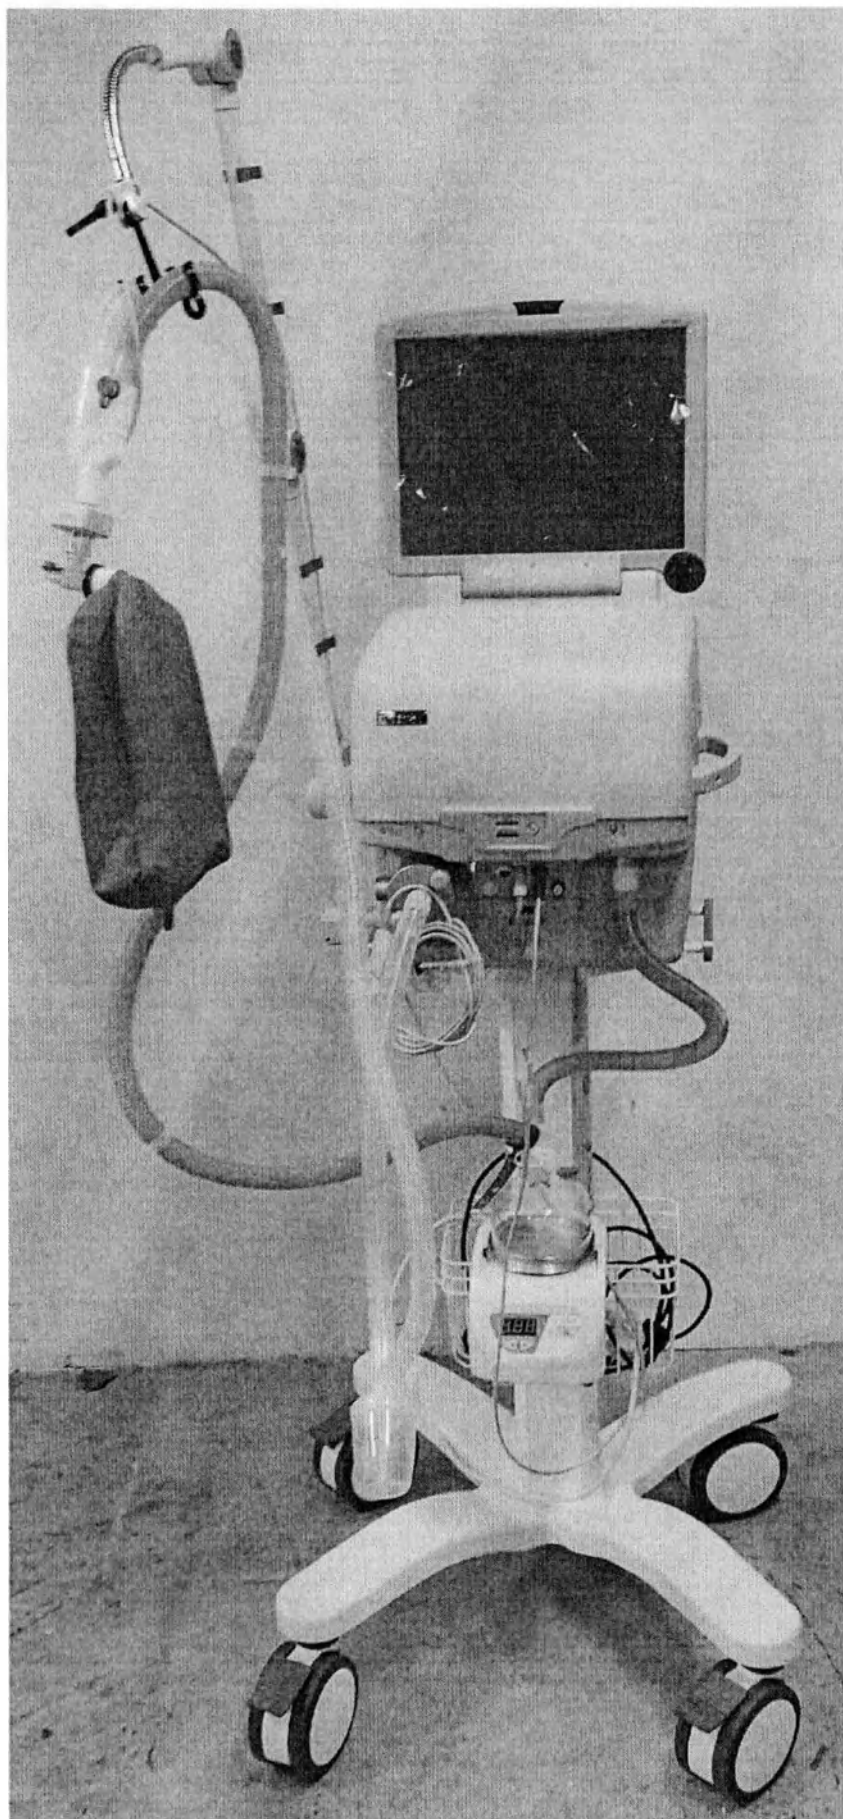

1 Электронный блок, ТЭСМ.230003, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




2 Фильтр-регулятор, ТЭСМ.186143, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

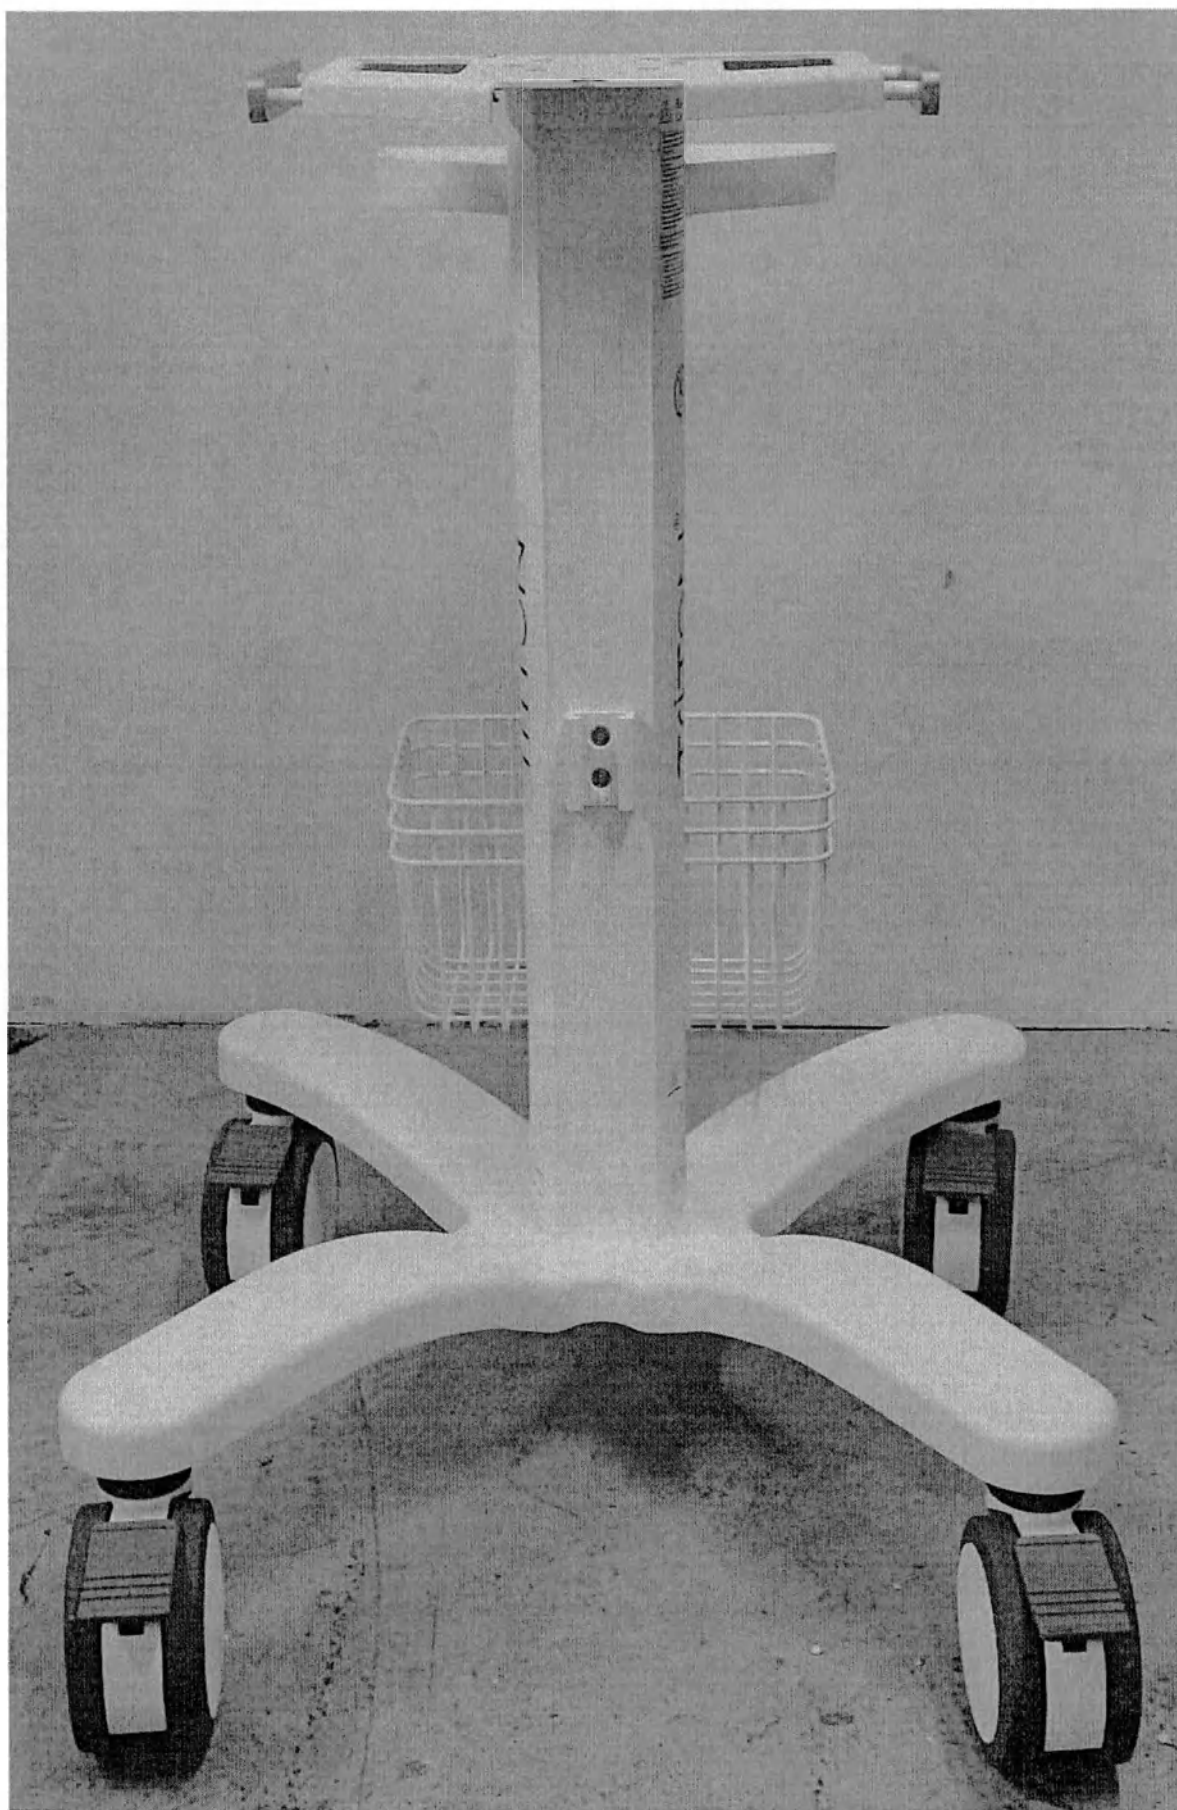


3 Тележка транспортная, ТЭСМ.186307, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




3 Тележка транспортная, ТЭСМ.186307-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

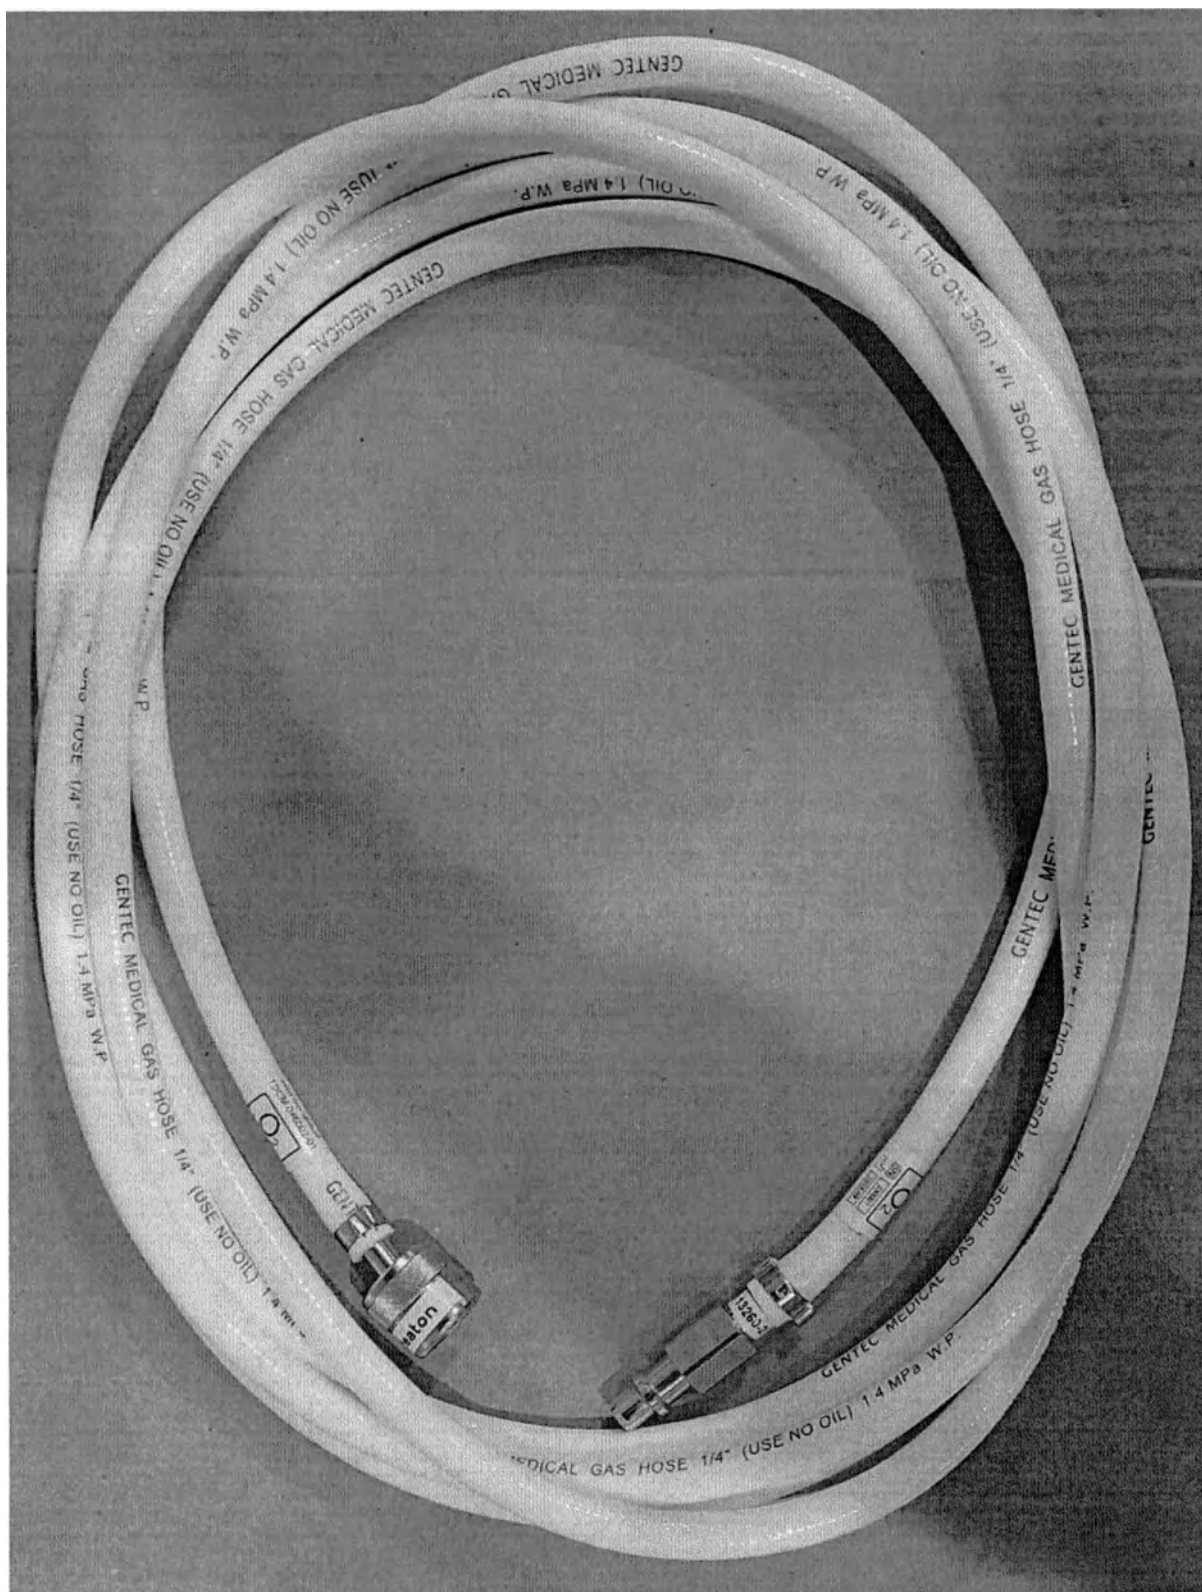


4 Шланг кислородный, ТЭСМ.046002-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

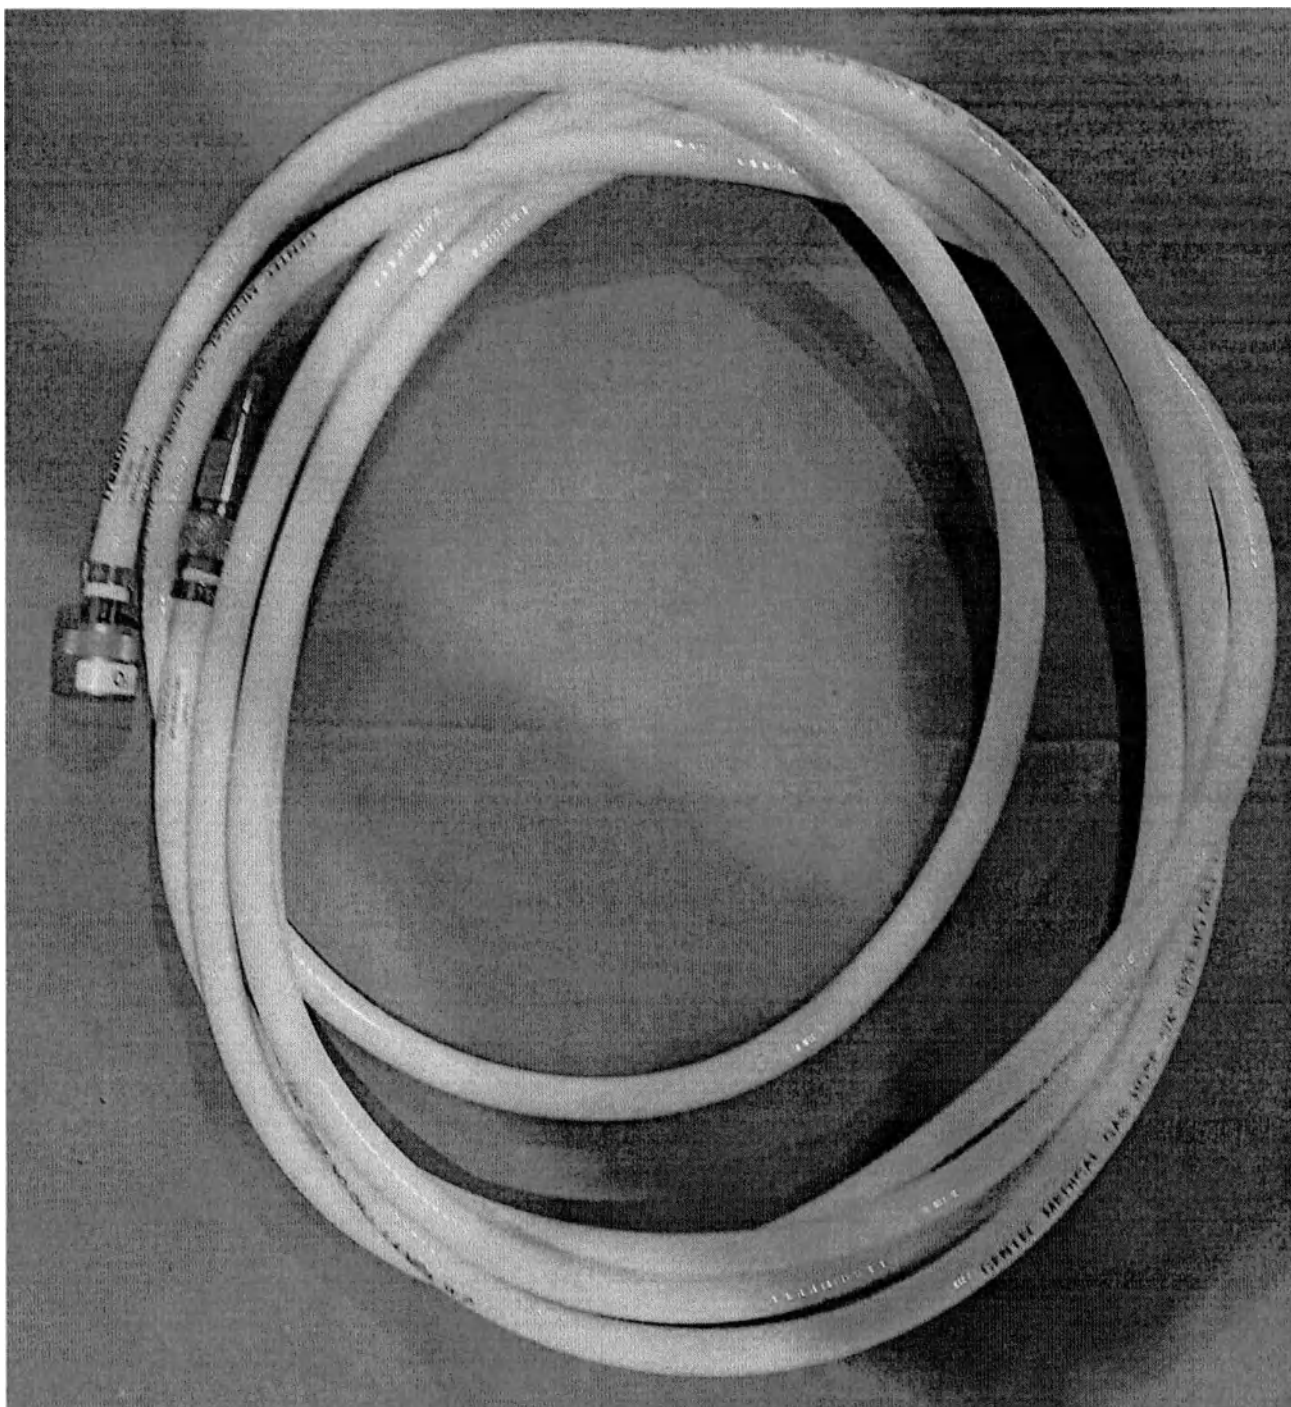


4 Шланг кислородный, ТЭСМ.046002-02, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

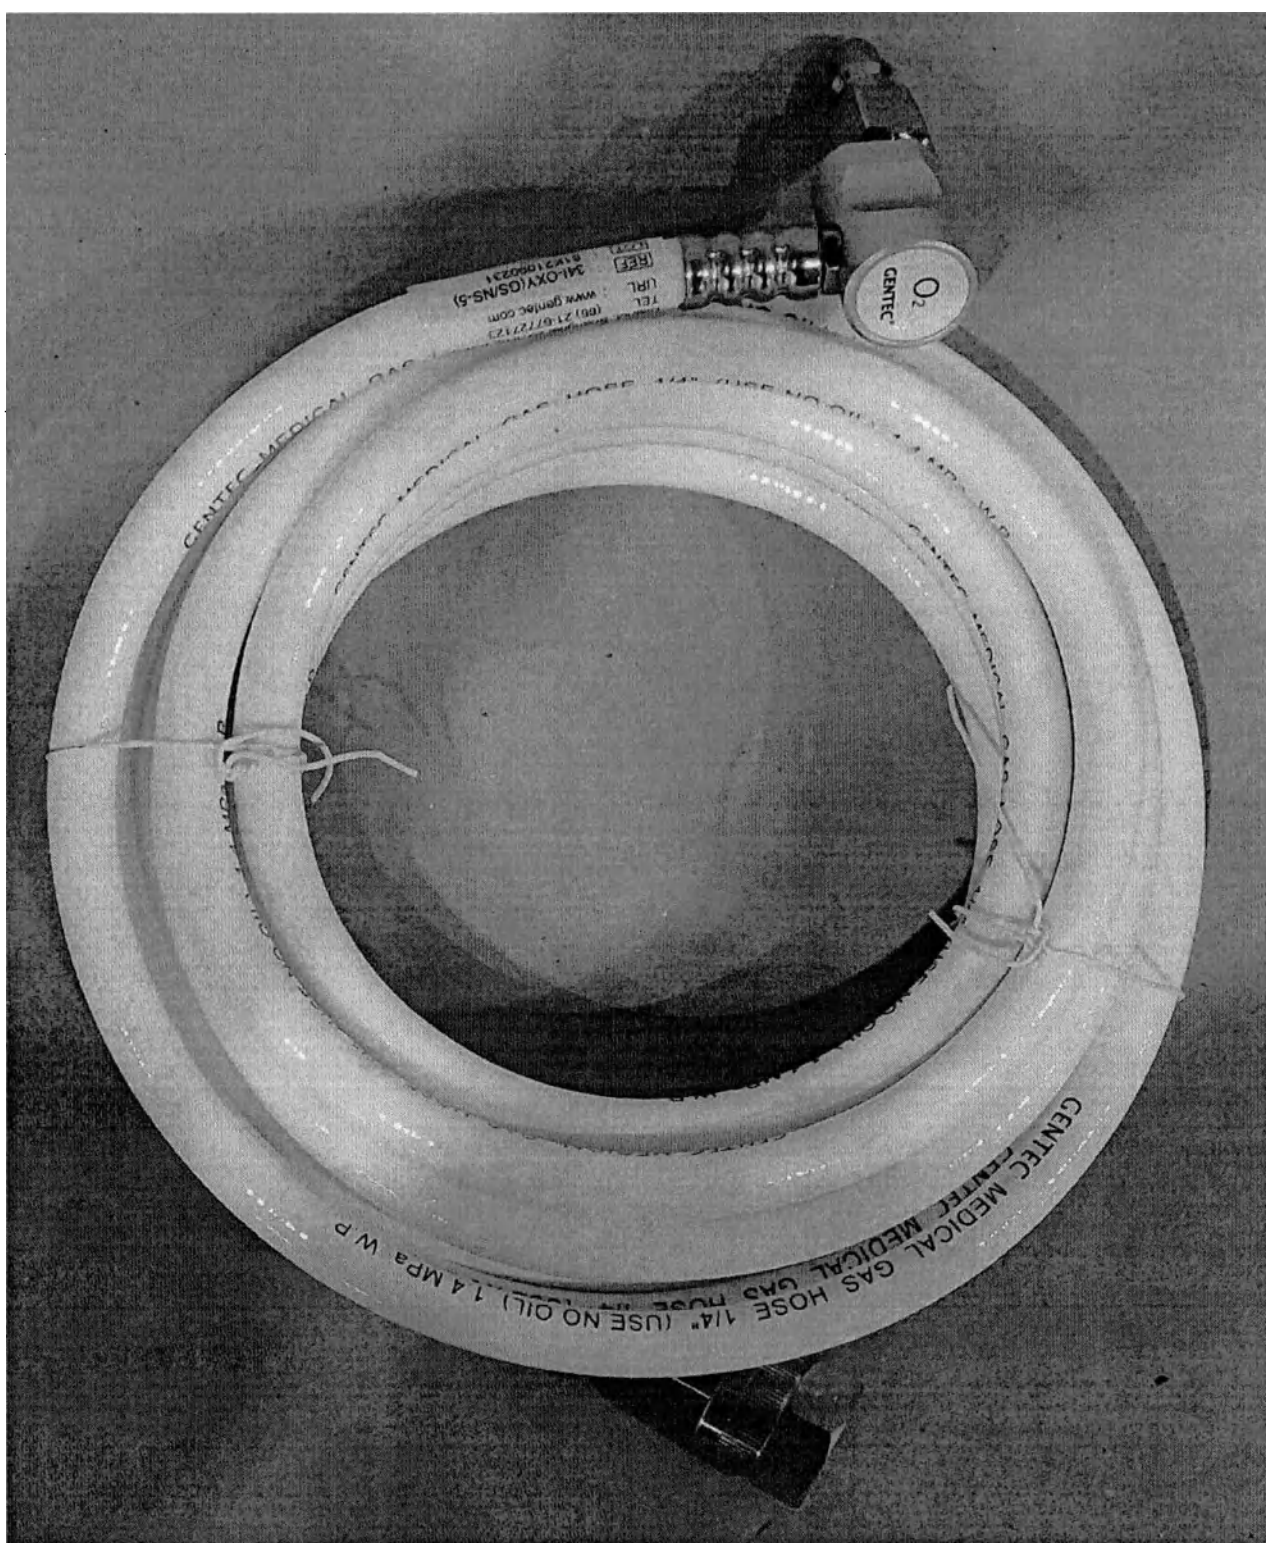


4 Шланг кислородный, 34I-OXY-GS/NS-5, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

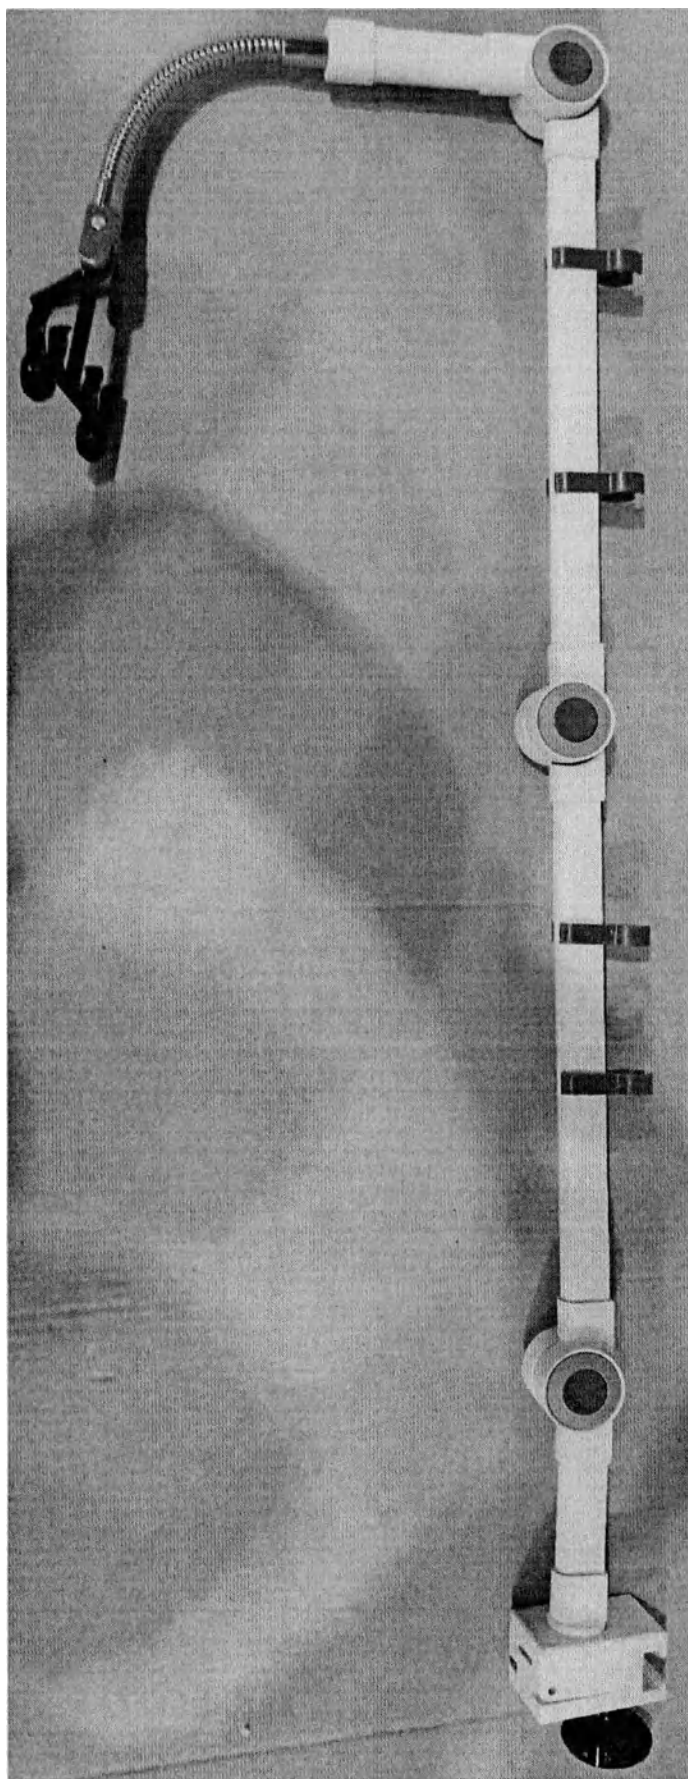

5 Штанга, WYAM030, Taizhou Weiye Machinery Manufacturing Co., Ltd, KHP

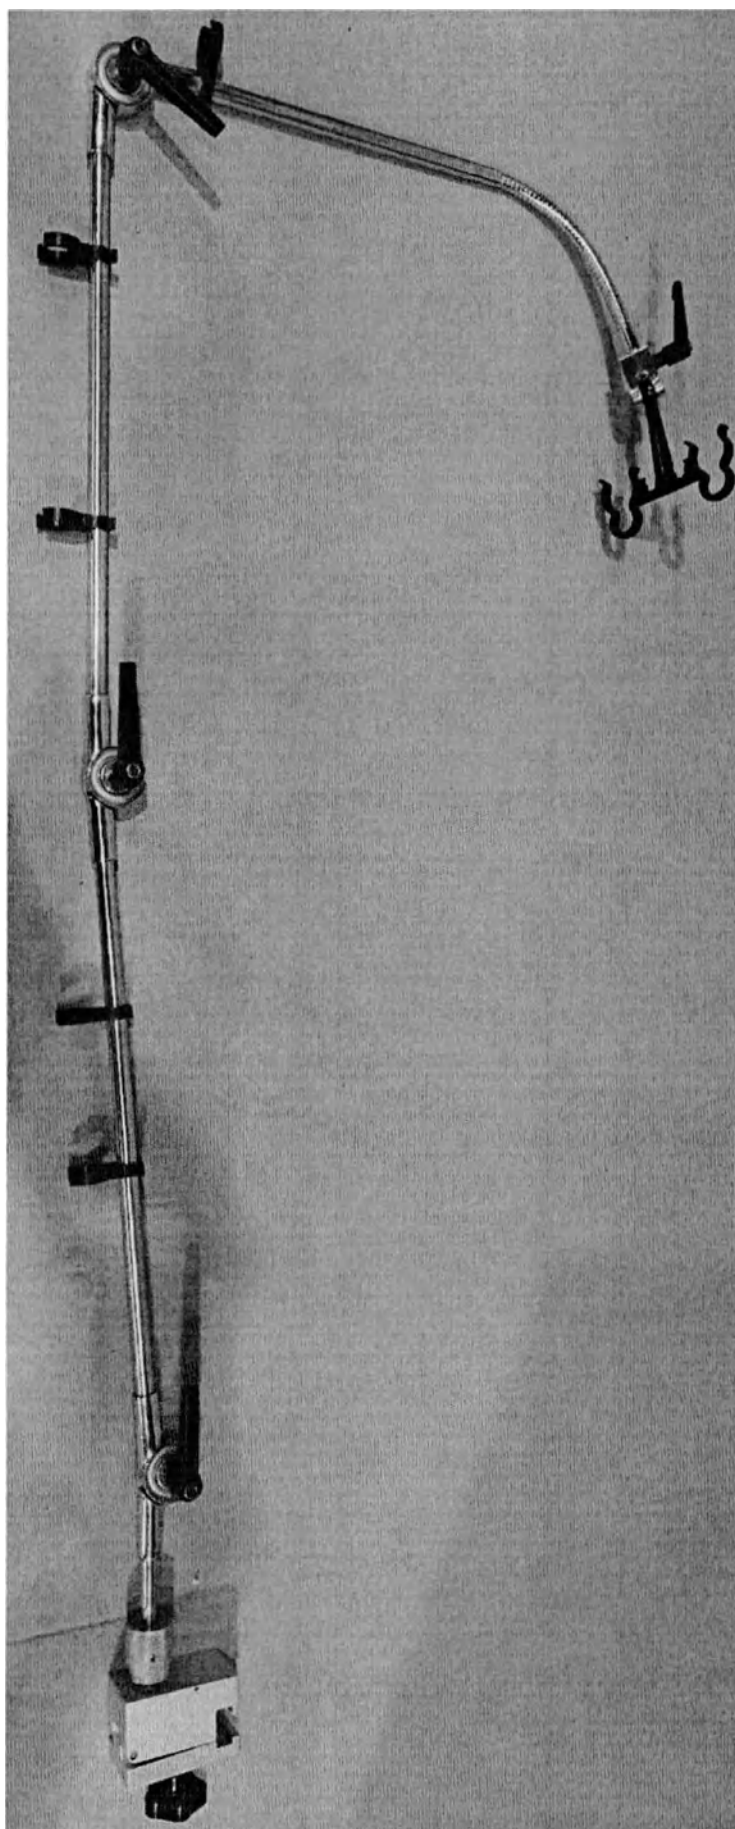


5 Штанга, WYAM010, Taizhou Weiye Machinery Manufacturing Co., Ltd, KHP

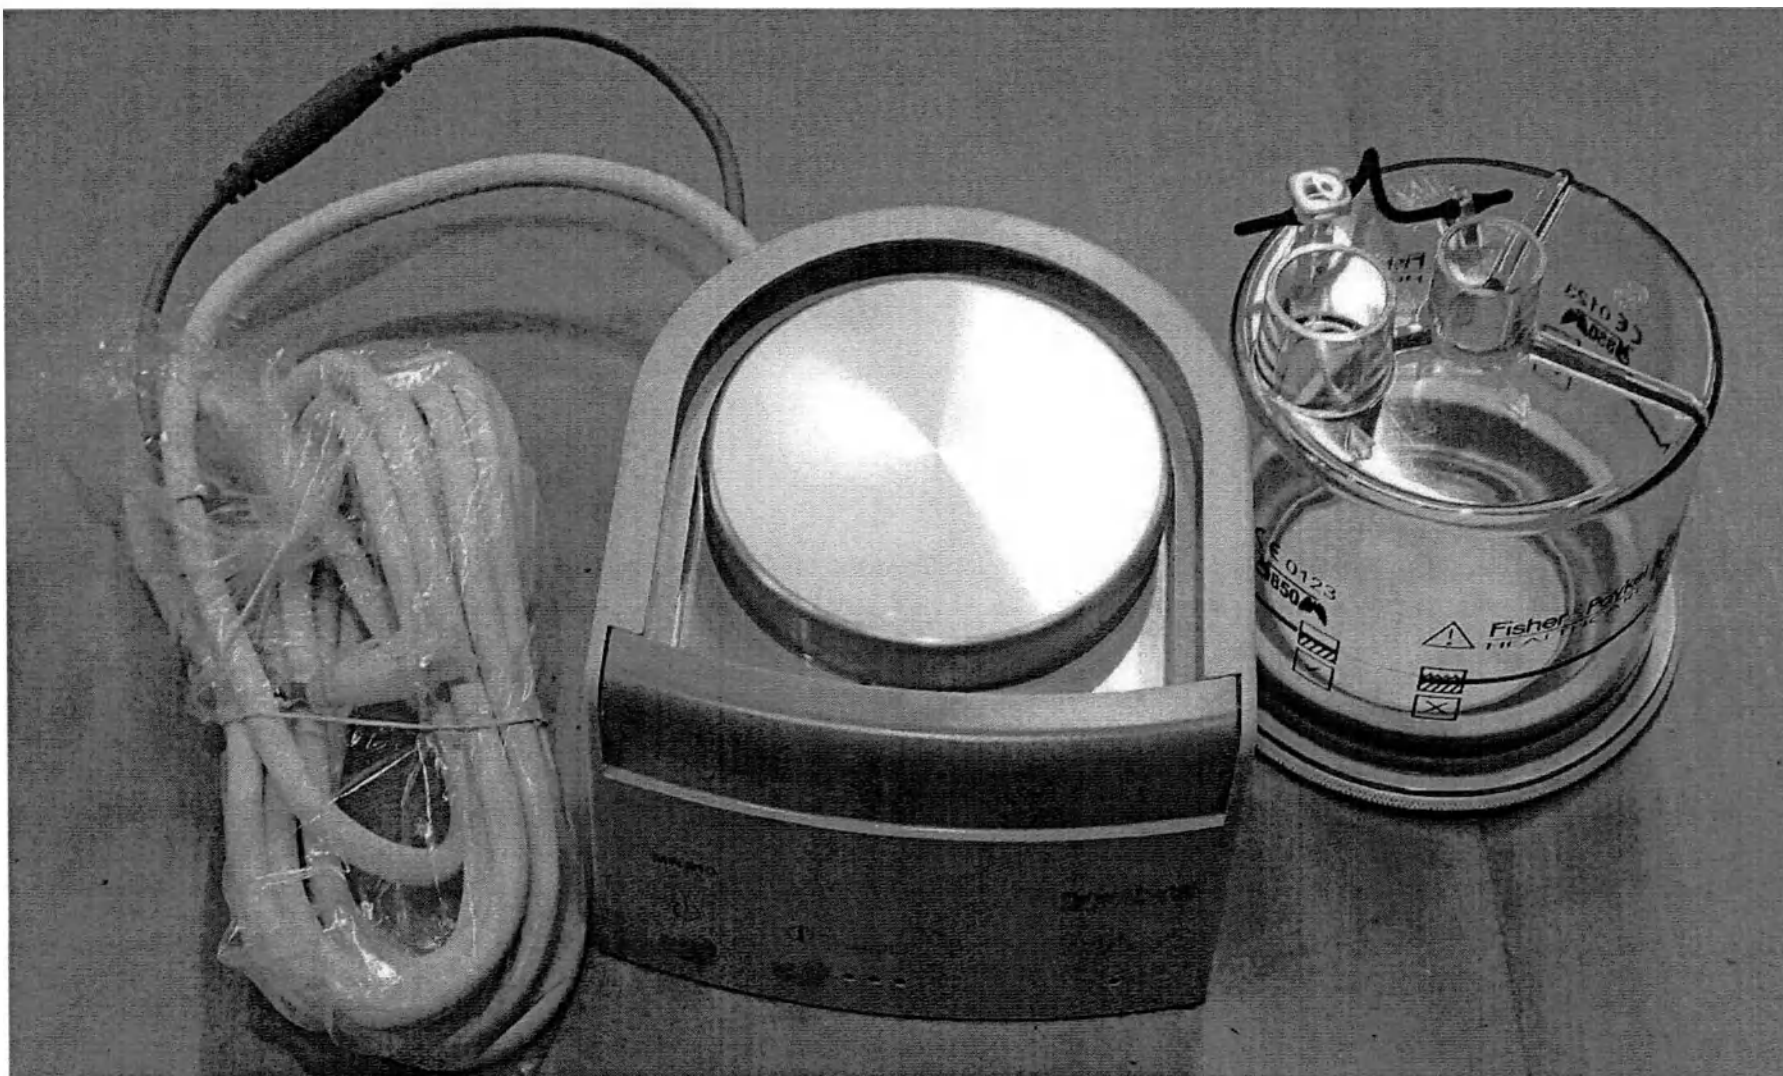


6 Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00742, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)



6 Камера увлажнителя MR370 из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00742, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

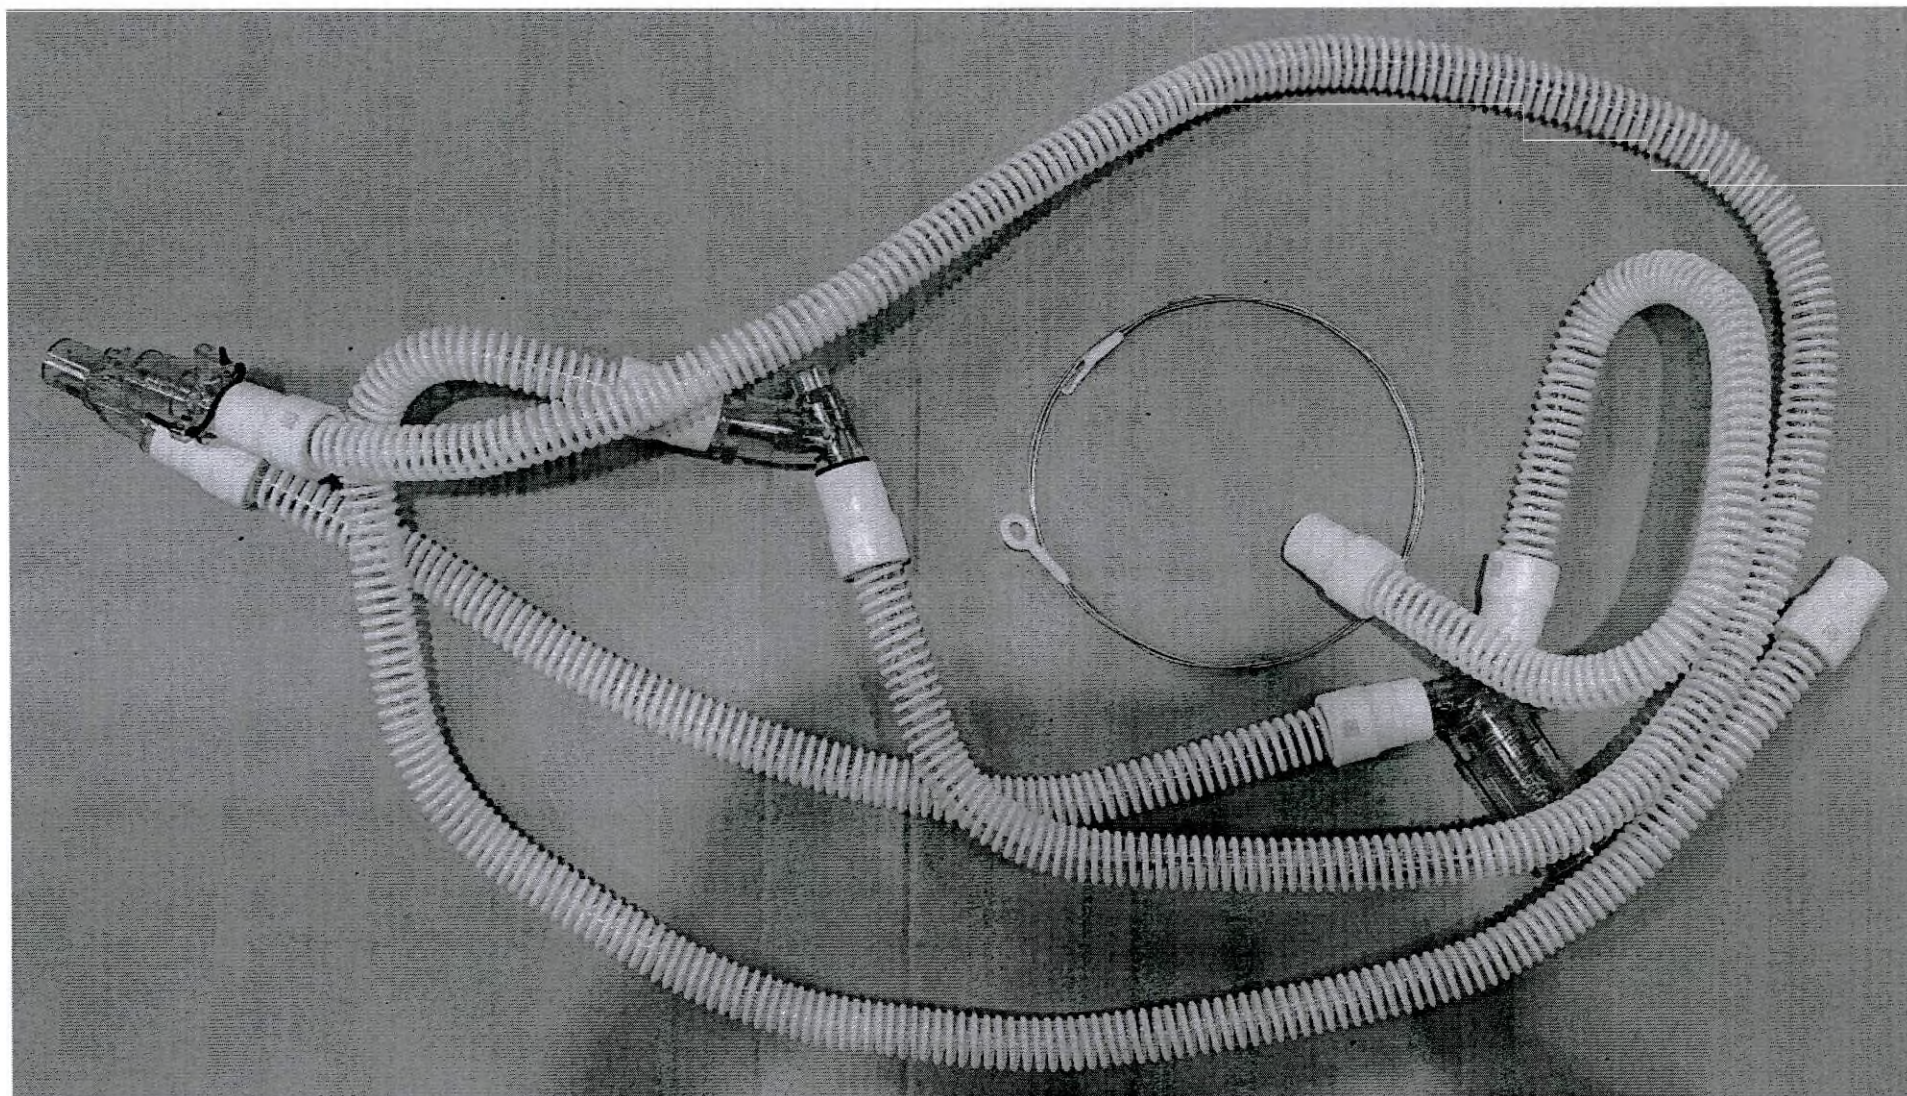


6 Дыхательный контур взрослый 900MR784 из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00742, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

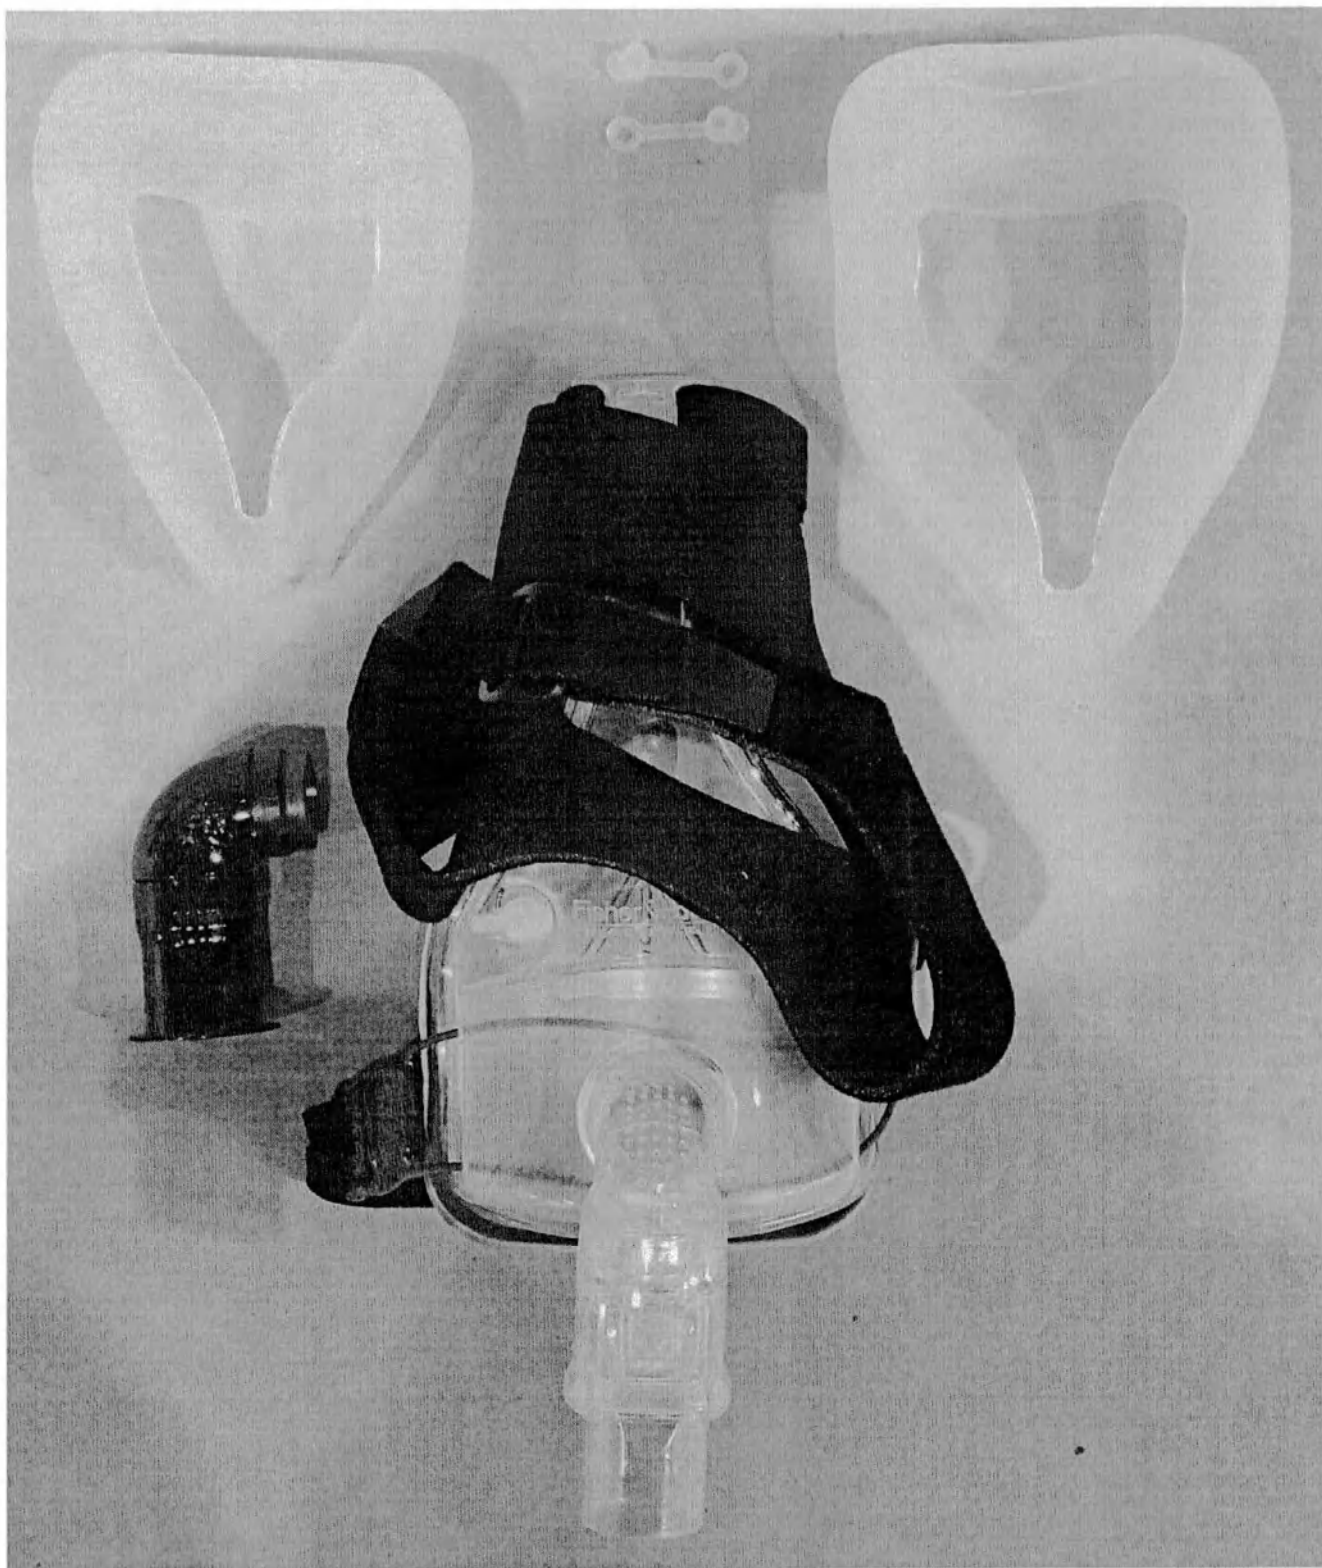


6 кислородная маска HC431NIV из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00742, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)




6 Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08292, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.)

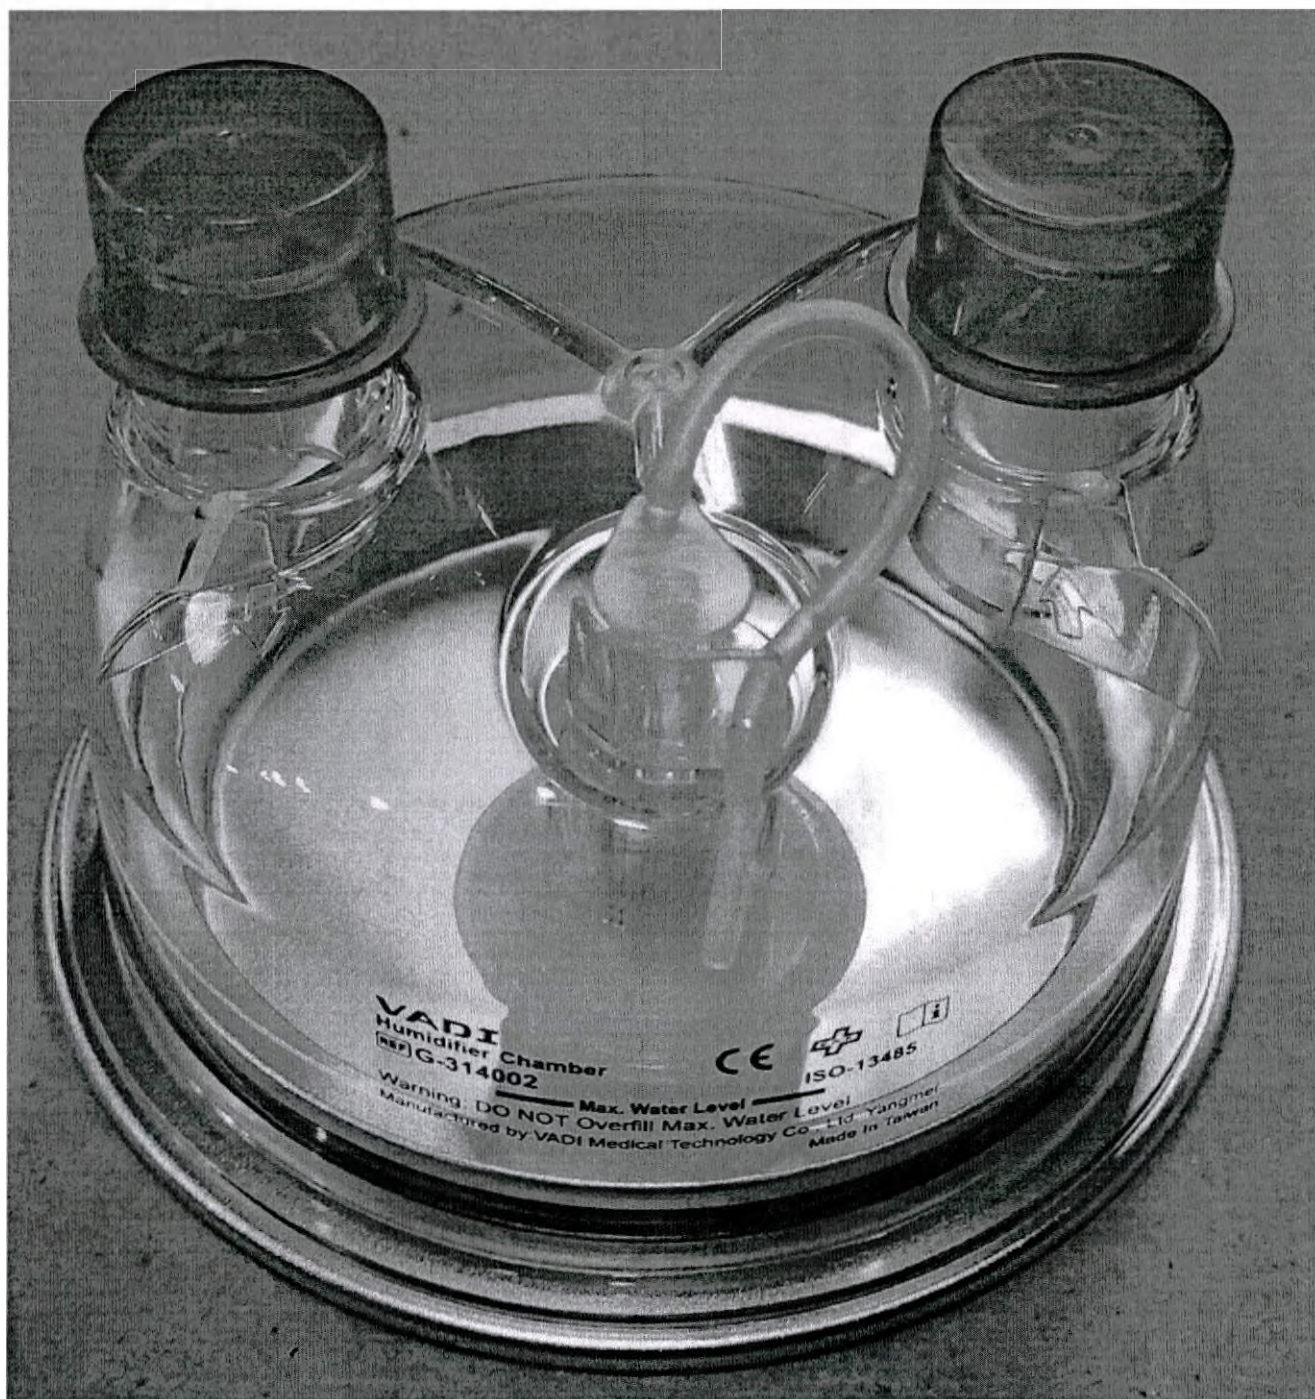

6 Камера увлажнителя, вариант исполнения: G-314002 из состава Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08292, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.)

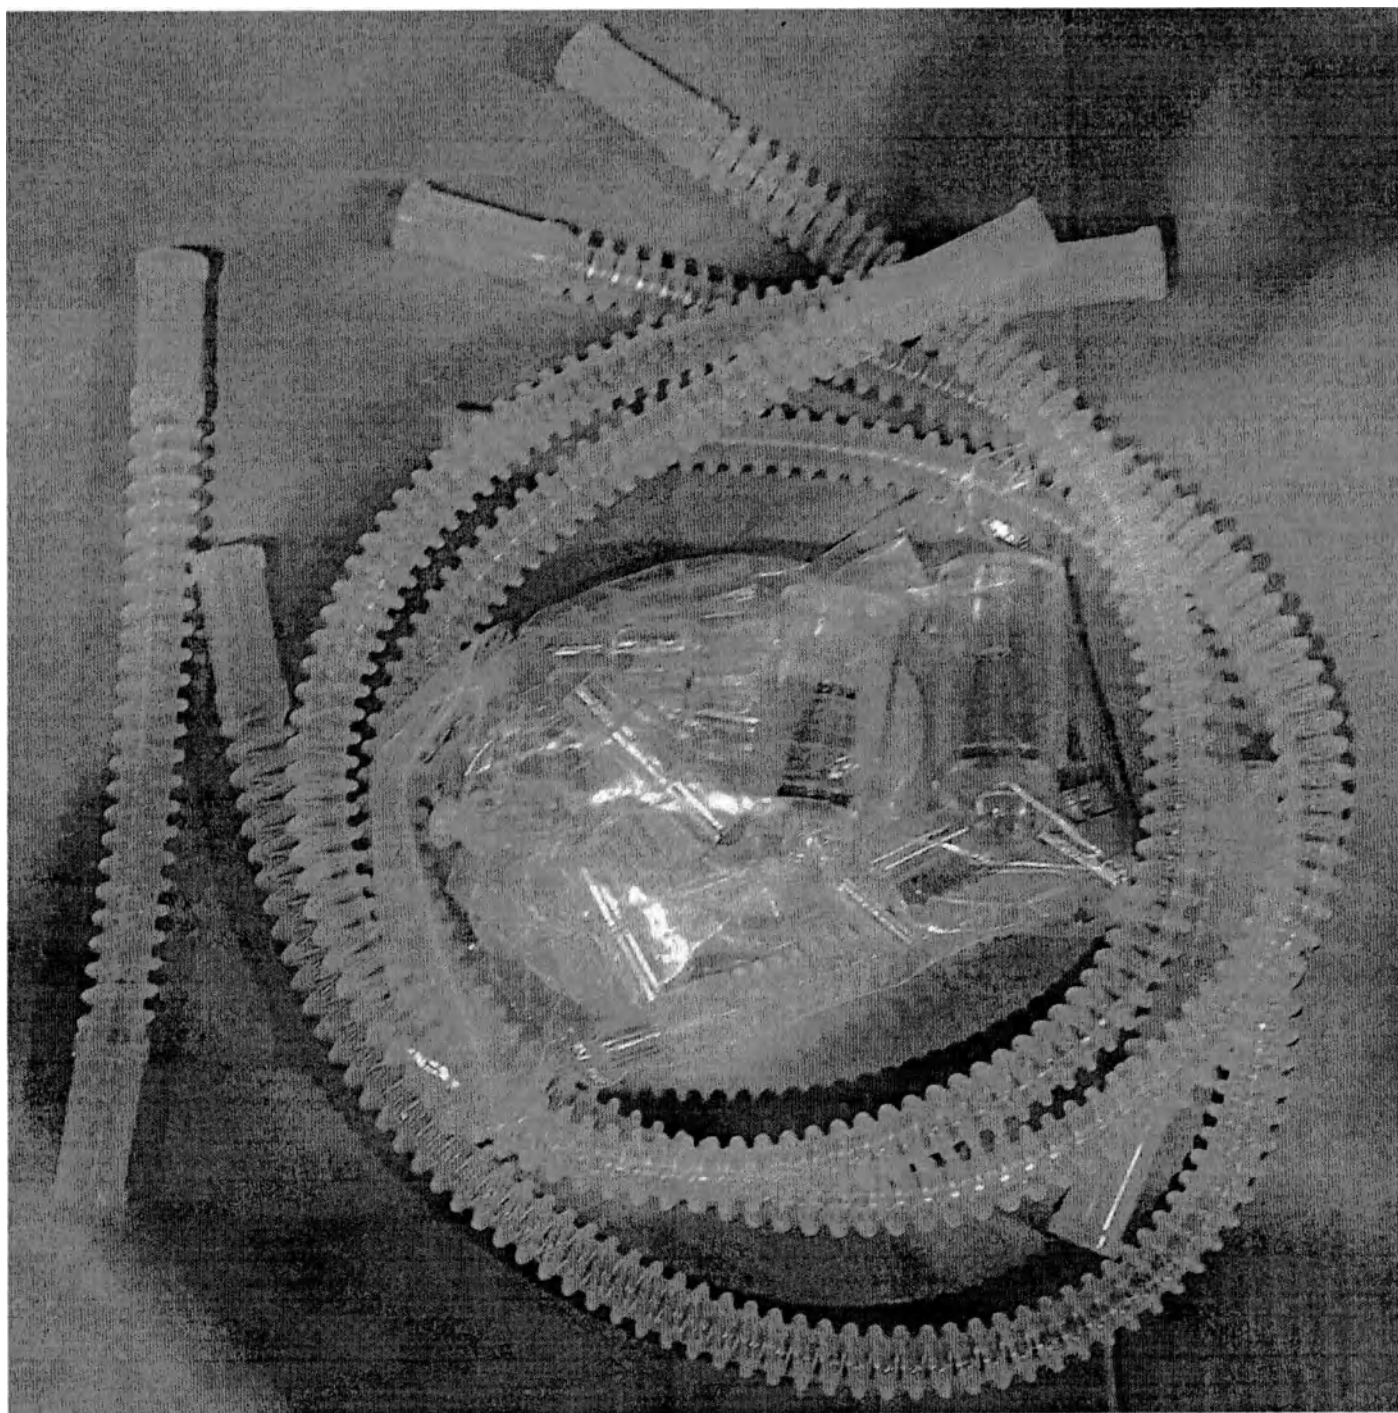


6 Контур дыхательный детский многоразовый, вариант исполнения: G-330000 из состава Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08292, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.)

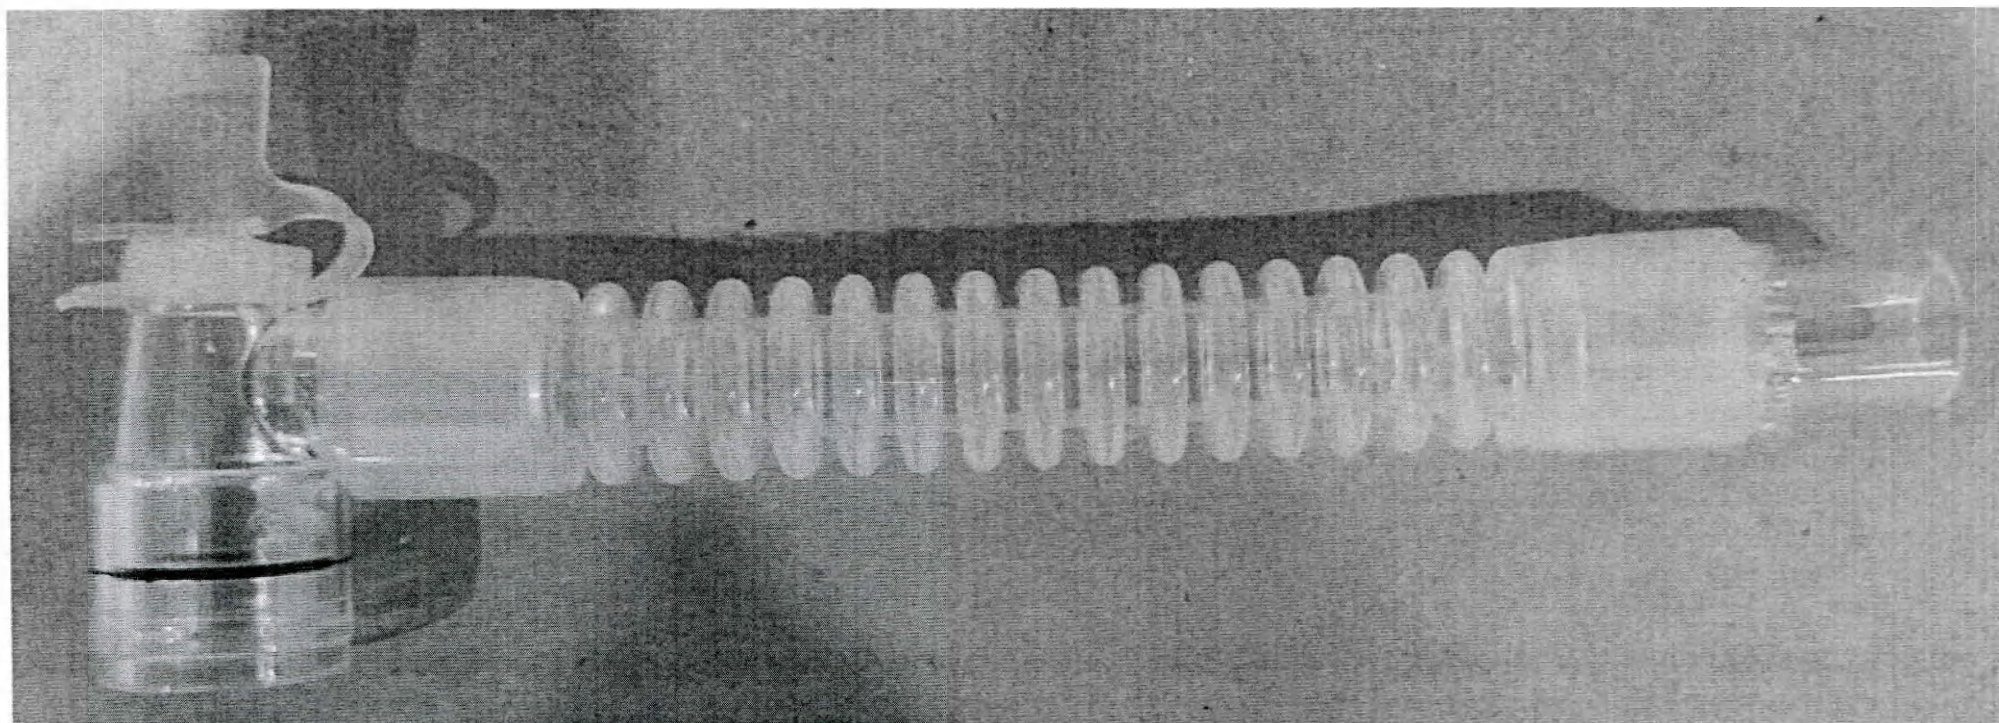


6 Трубка гофрированная с коннектором (flex tube), вариант исполнения G-322011 из состава Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08292, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.)



6 Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1416, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

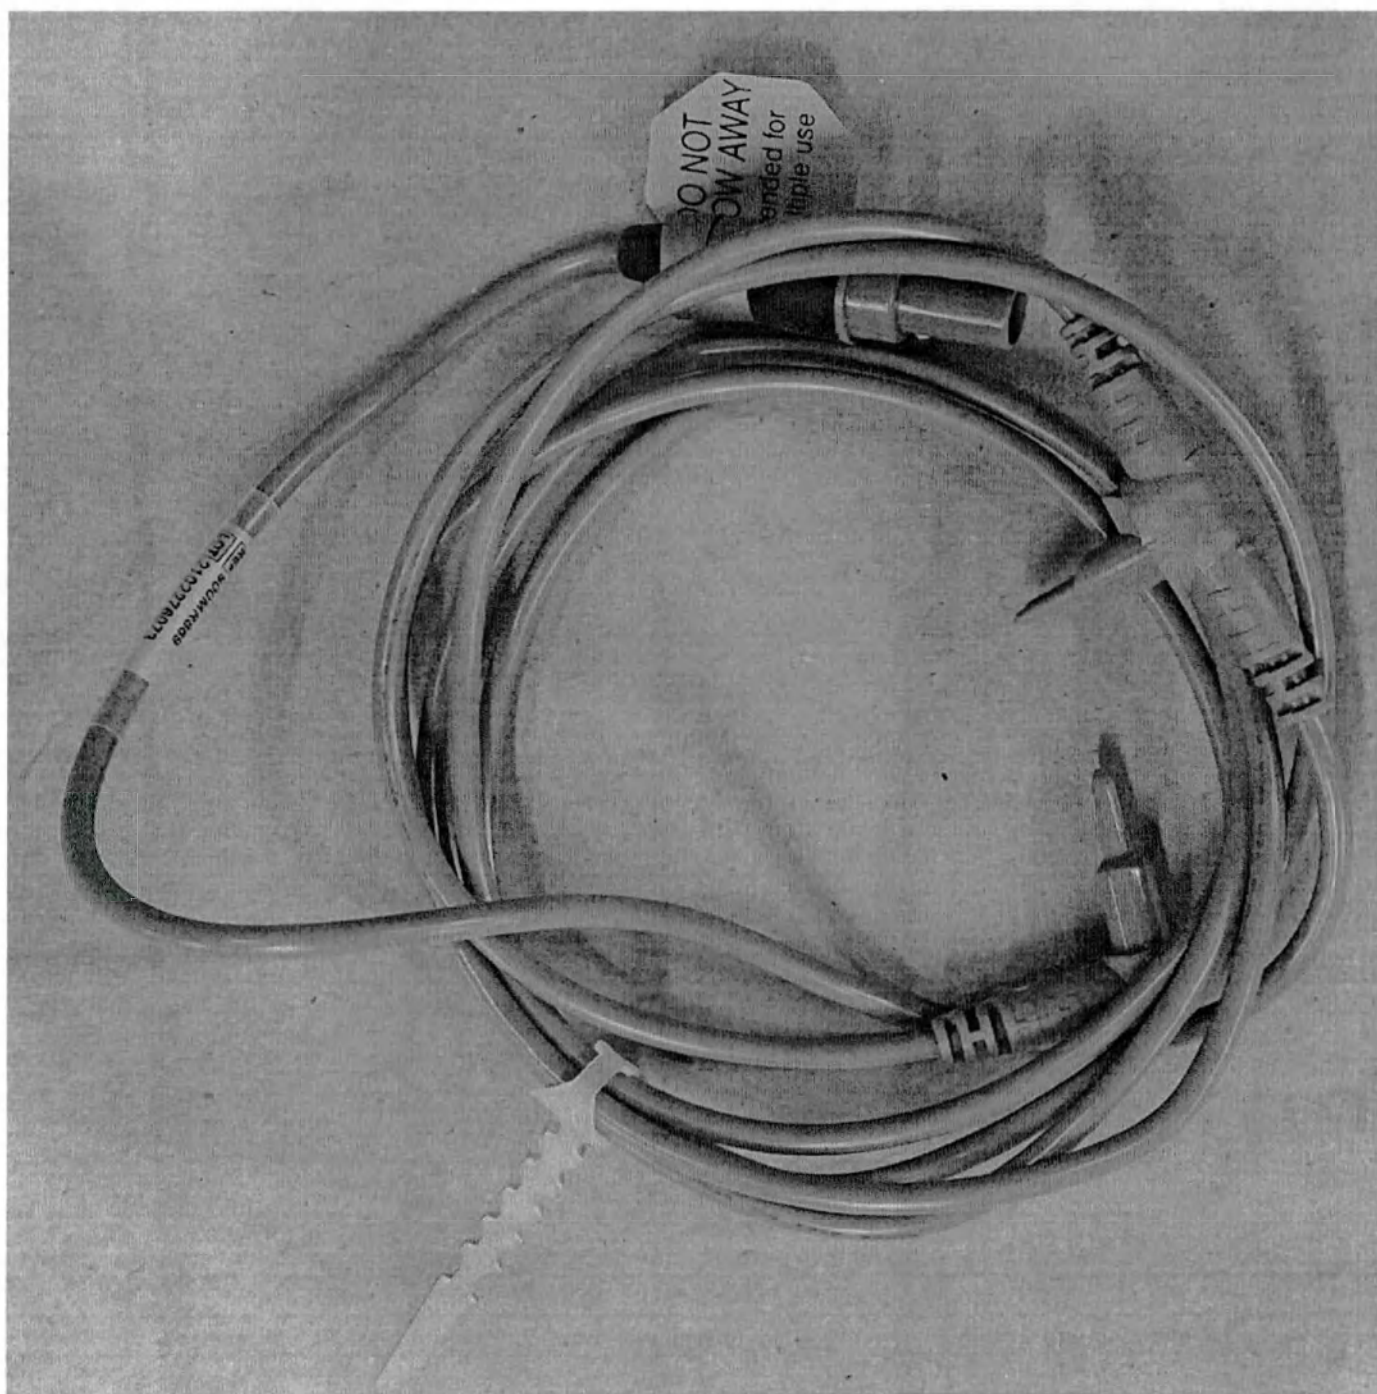

6 Температурный датчик для увлажнителя, вариант исполнения 900MR869 из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1416, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

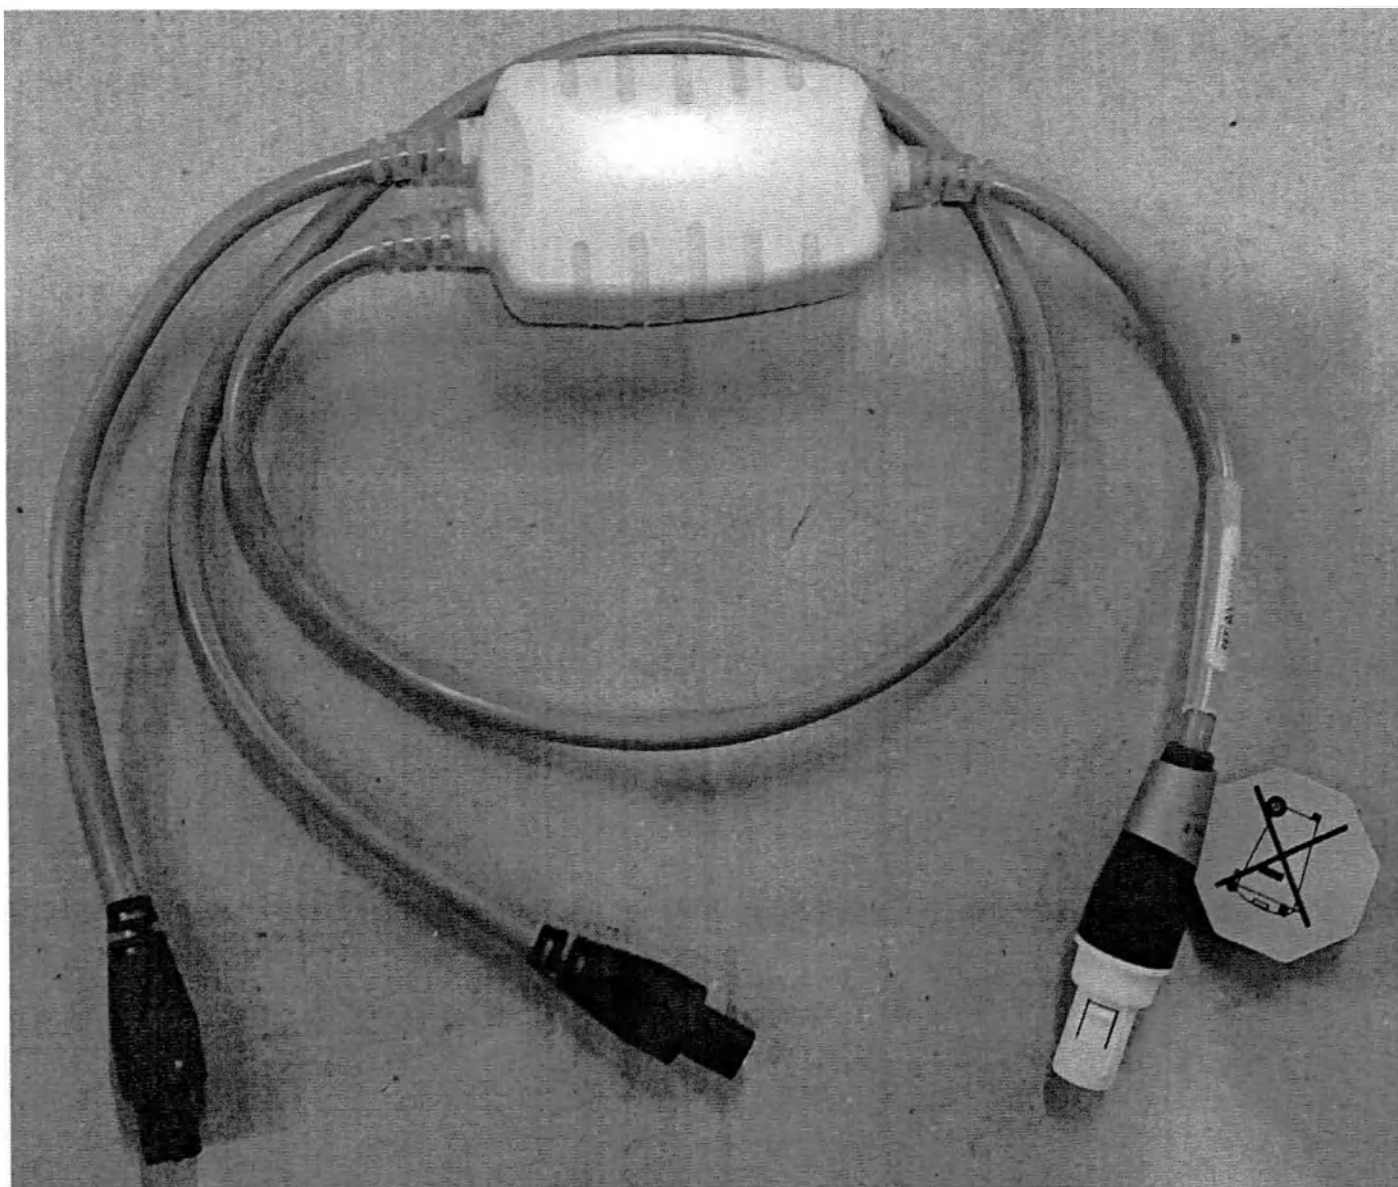

6 Кабель гибкого нагревателя, вариант исполнения 900MR805 из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1416, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)



6 Камера увлажнителя, вариант исполнения MR370 из состава Увлажнителя дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1416, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)




6 Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия




6 Блок управления 3703.01100000 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия



6 Датчик температуры / влажности 3703.41000000 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия

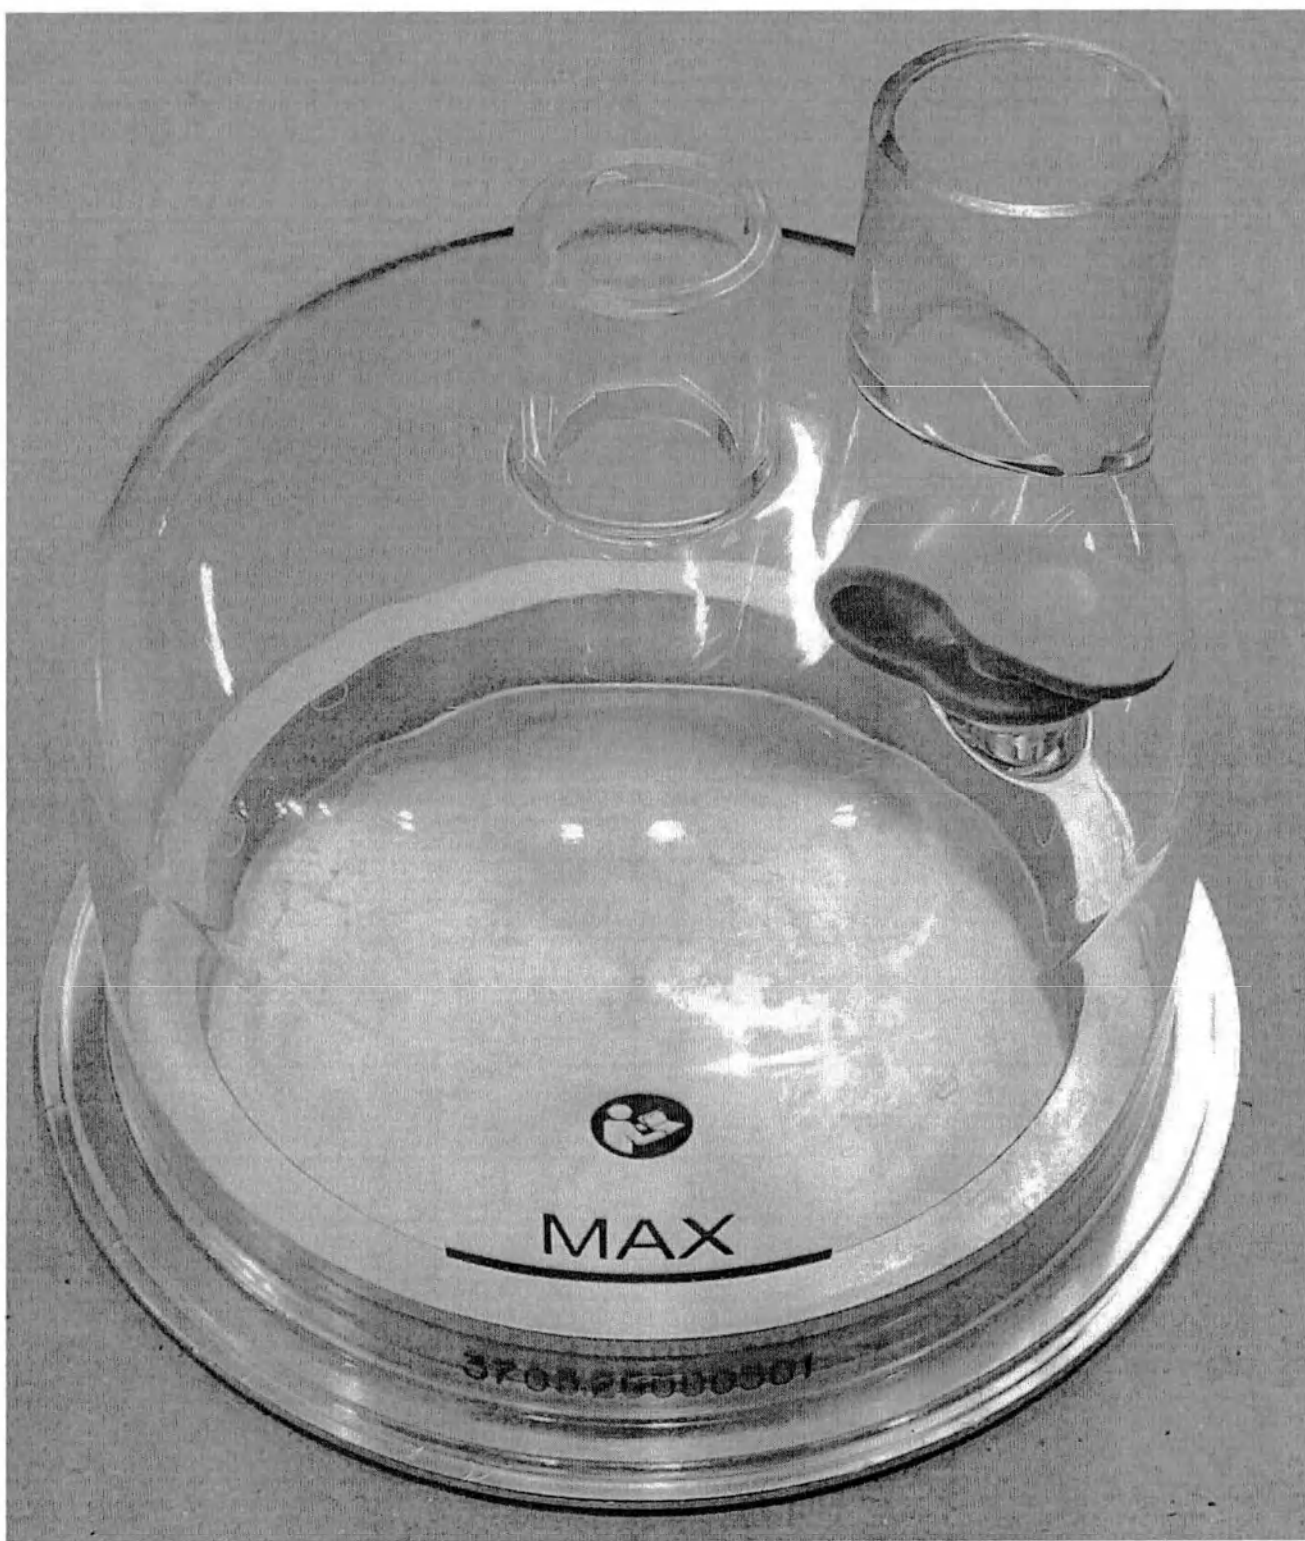

6 Камера увлажнителя многокамерная 3703.20000501 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия

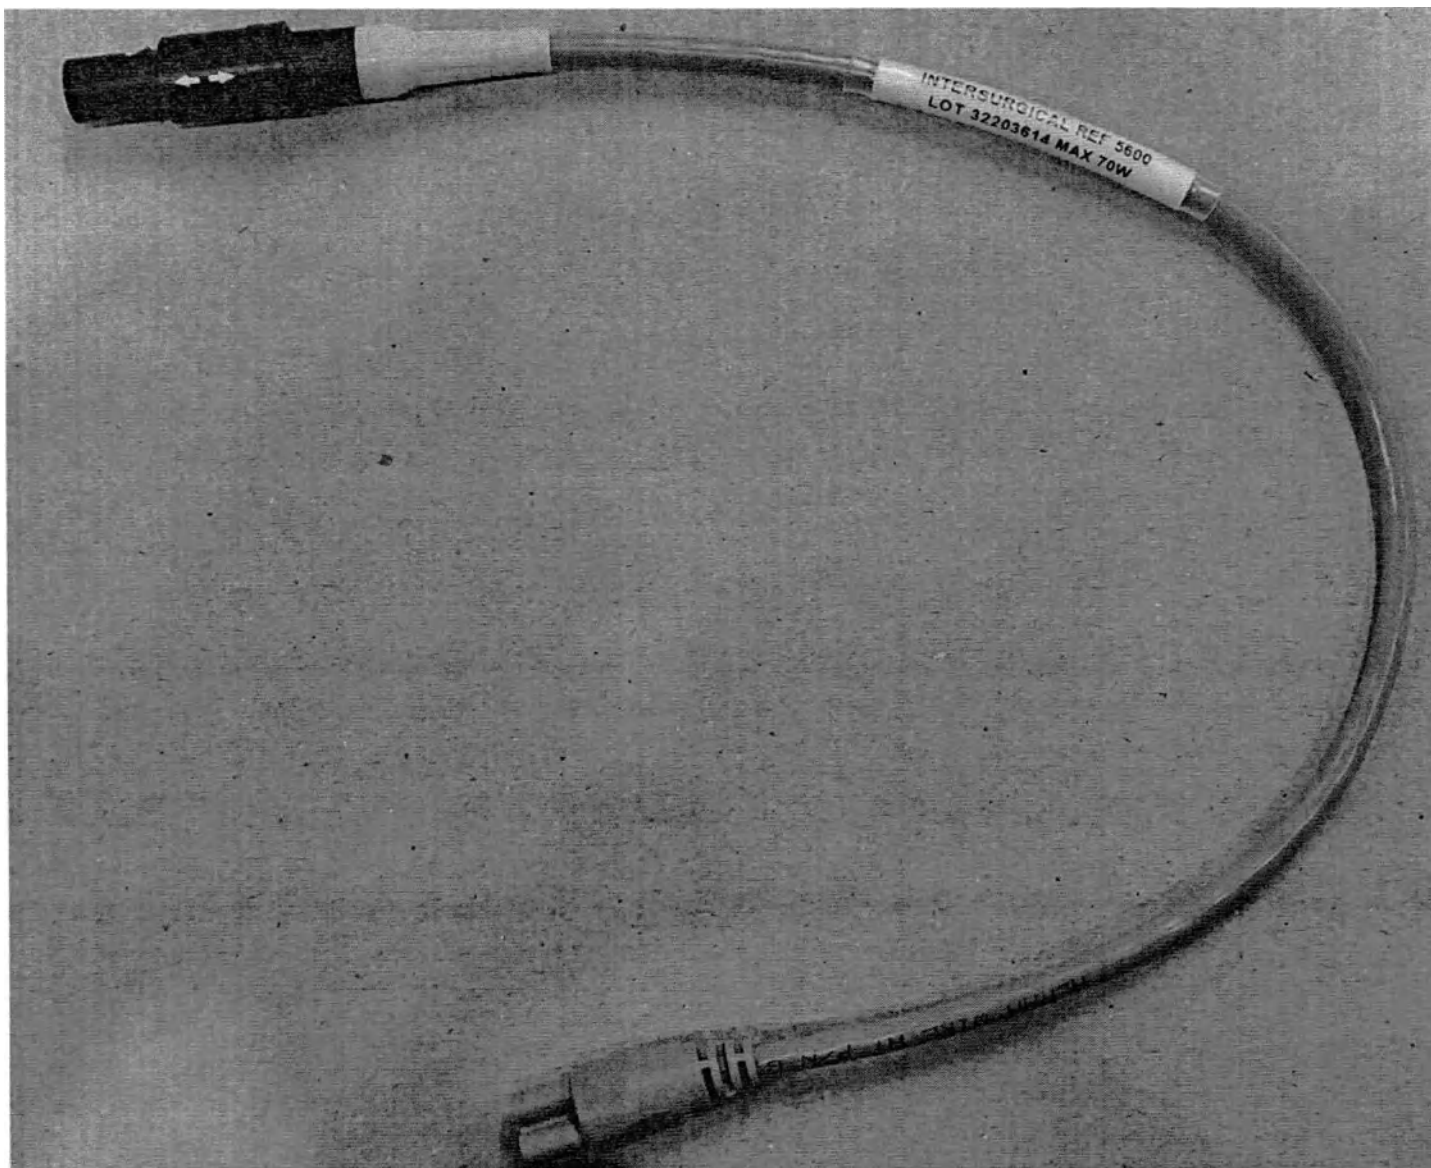

6 Адаптер нагревательного провода для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха 5600000 («Intersurgical Ltd», Великобритания), РУ № ФСЗ 2009/03551 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия



6 Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000-01, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия




6 Блок управления 3703.01100000-01 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000-01, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия




6 Камера увлажнителя многокамерная 3703.20000501 в составе Увлажнителя дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения 3703.00000000-01, РУ № РЗН 2015/2620, АО «ПО «УОМЗ», Россия


7 Комплект дыхательного контура многоразовый ТЕСН.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

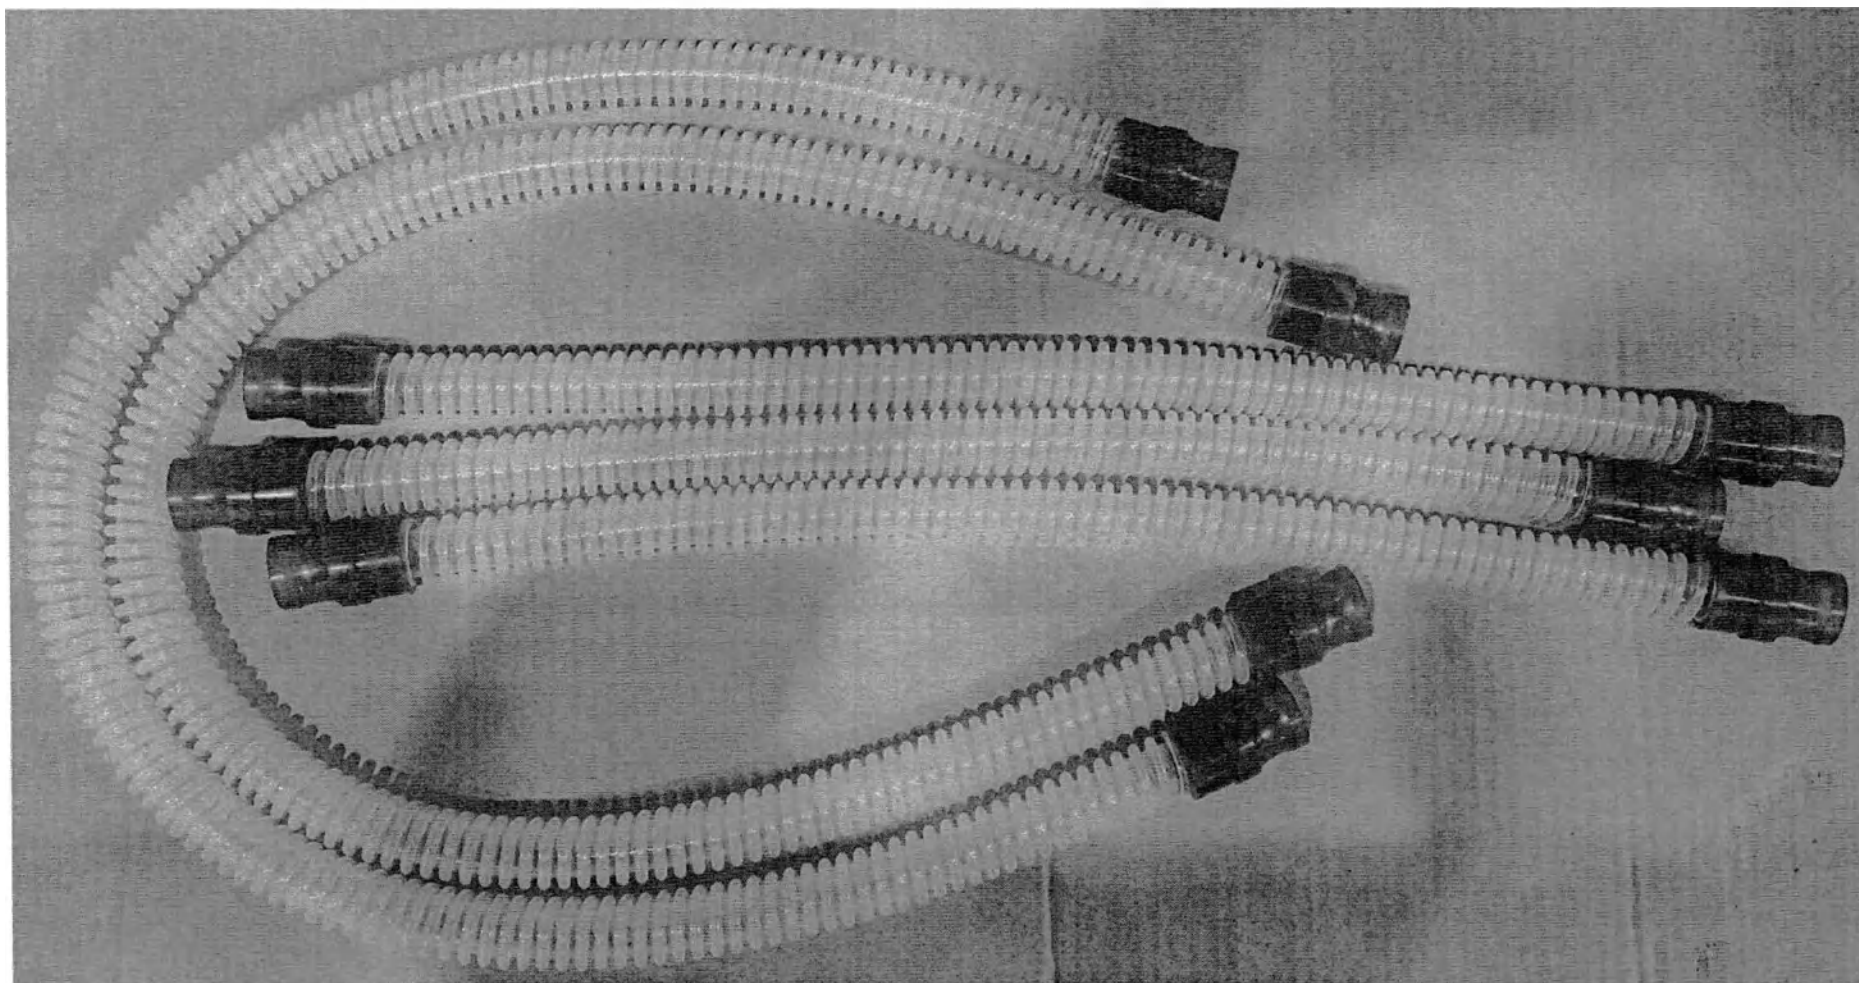


7.1 Трубки гофрированные силиконовые для дыхательных аппаратов ТГСД по ТУ 9444-016-48423543-2007, ТГСД 15, РУ № ФСР 2008/03244, ООО «РТИ Силиконы», Россия, в составе Комплекта дыхательного контура многоразовый ТЕСН.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

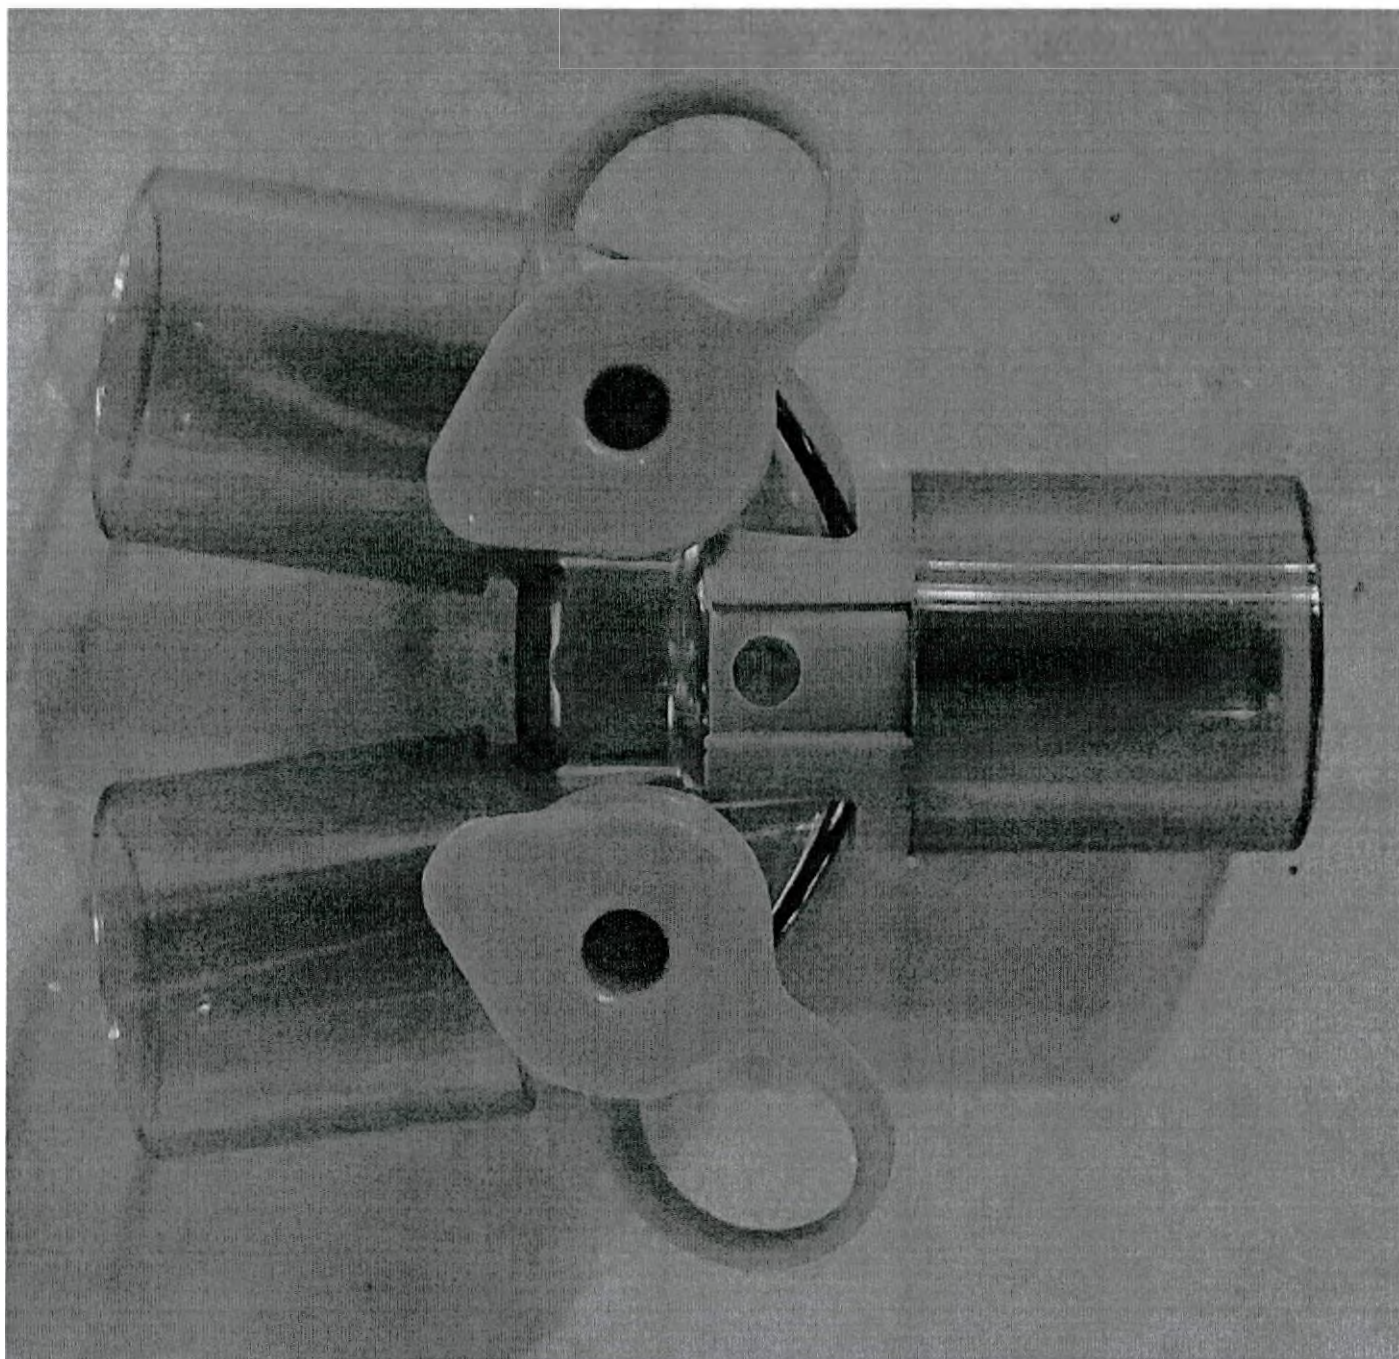

7.2 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель с портами, без линий мониторинга: жесткий; Y-образный, 9116000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Комплекта дыхательного контура многоходовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

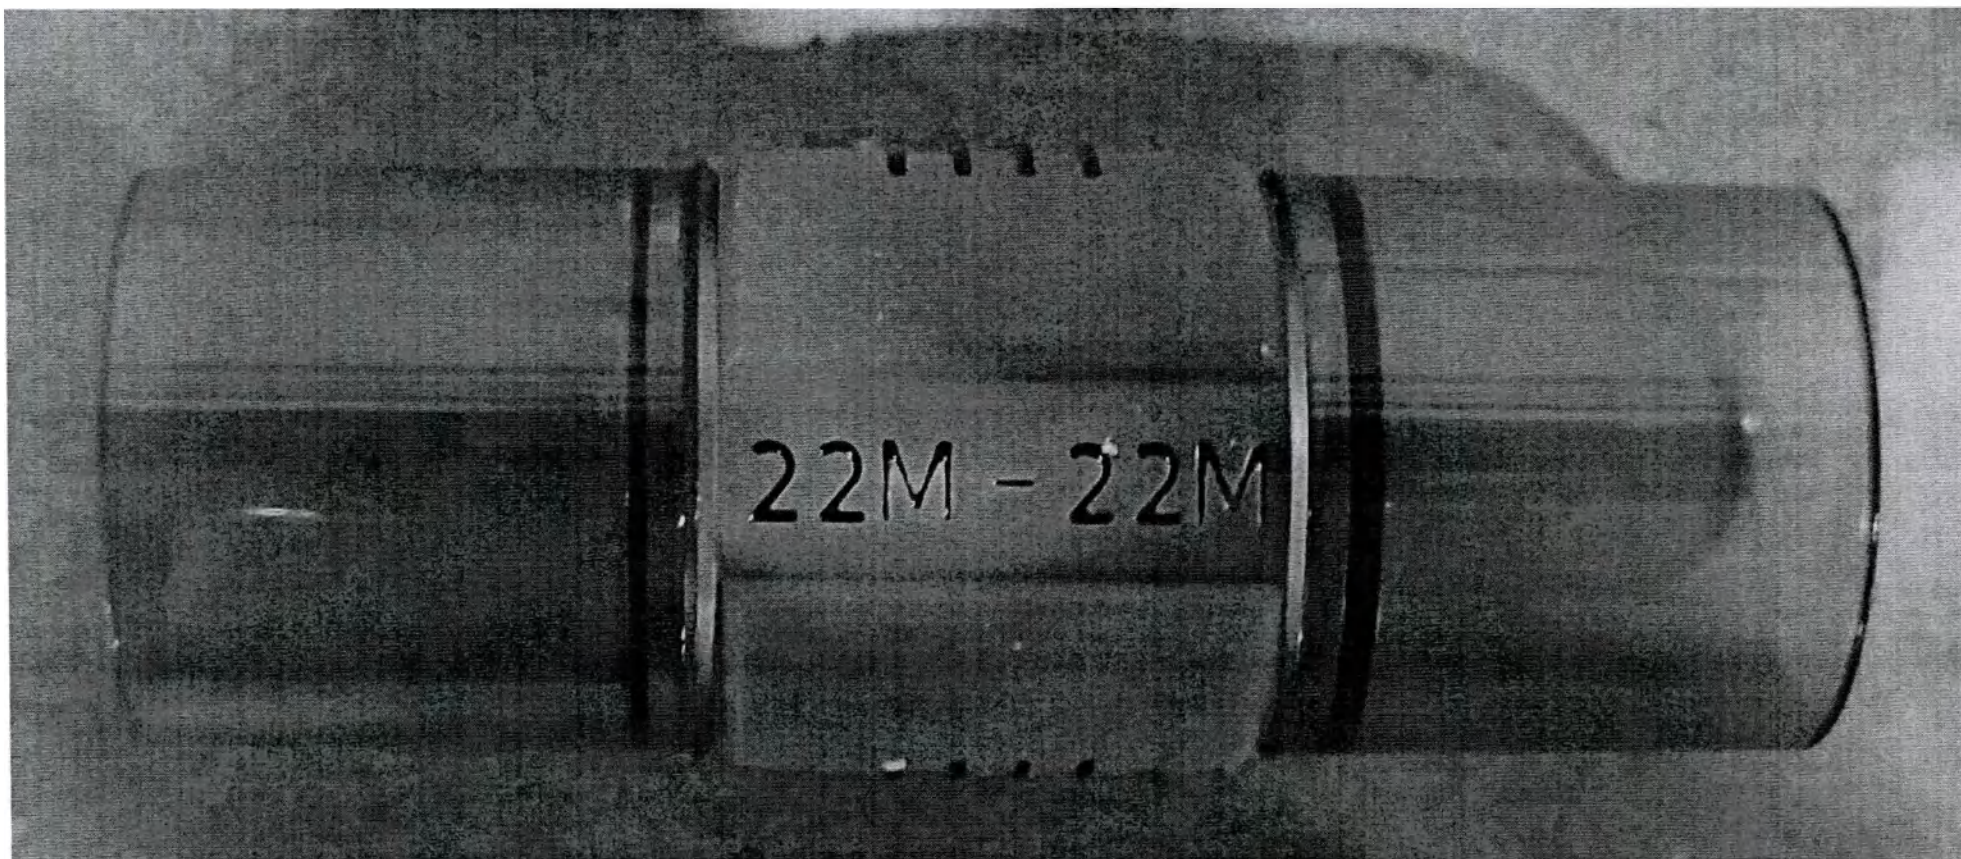


7.3 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель без портов и линий мониторинга: жесткий; прямой, 9110000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Комплекта дыхательного контура многоходовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

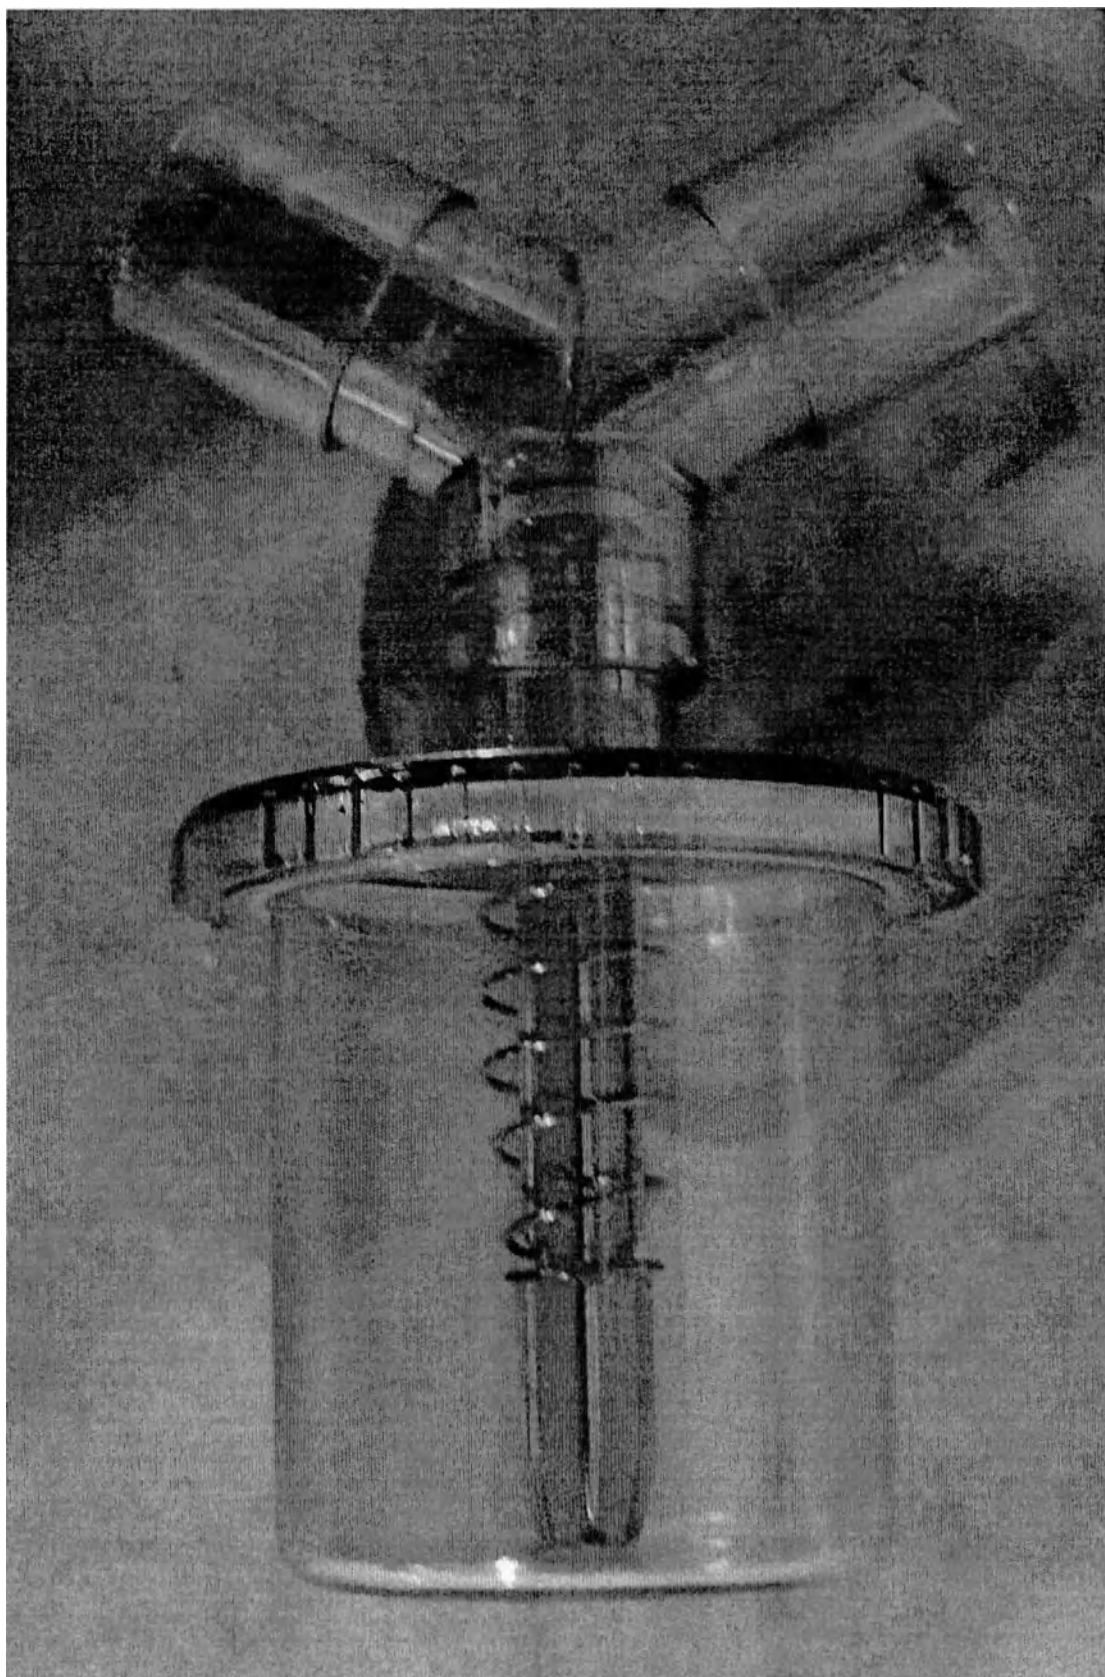


7.4 Влагосборник, 668-002Е, Gentec (Shanghai) Corporation, КНР, в составе Комплекта дыхательного контура многоразовый TECH.233015, ООО фирма «Тригон-ЭлектроникС», Россия



7.5 Гибкий нагреватель, 900150L, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.), в составе Комплекта дыхательного контура многоходовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

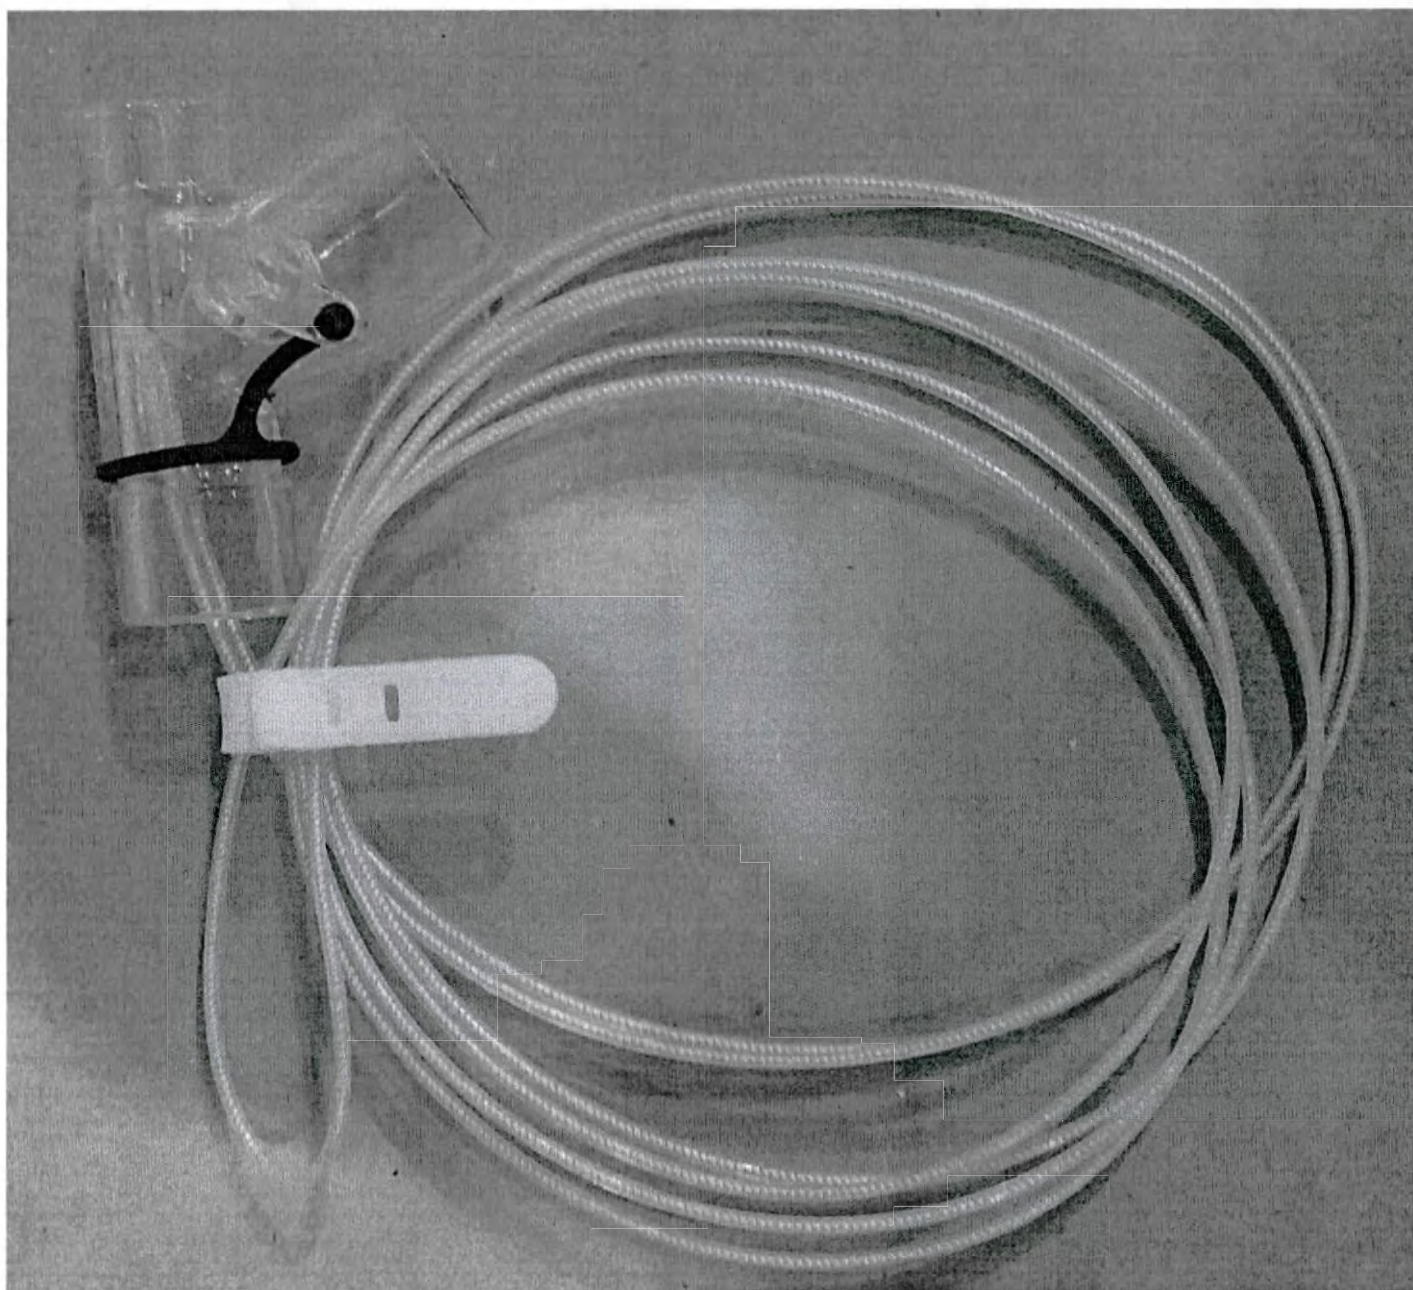


7.5 Гибкий нагреватель, 900130L, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.), в составе Комплекта дыхательного контура многоразовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

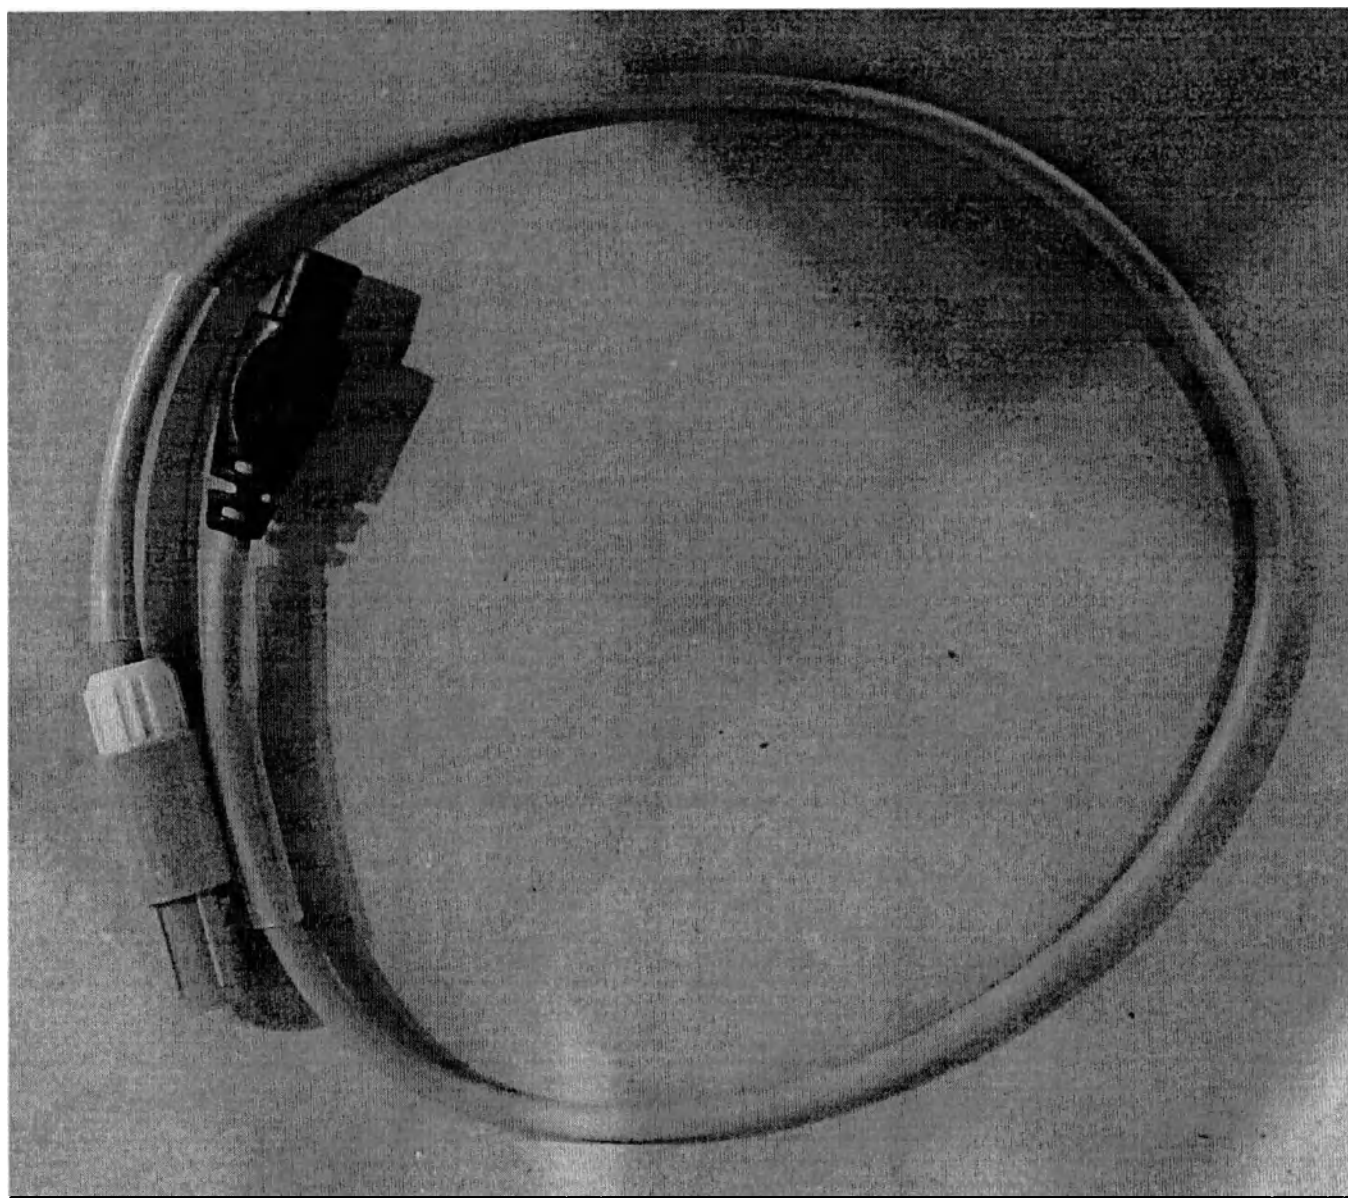

7.6 Кабель питания, VH30100, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.), в составе Комплекта дыхательного контура многоходовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




7.7 Адаптер, VH30C, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.), в составе Комплекта дыхательного контура многоцветный TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

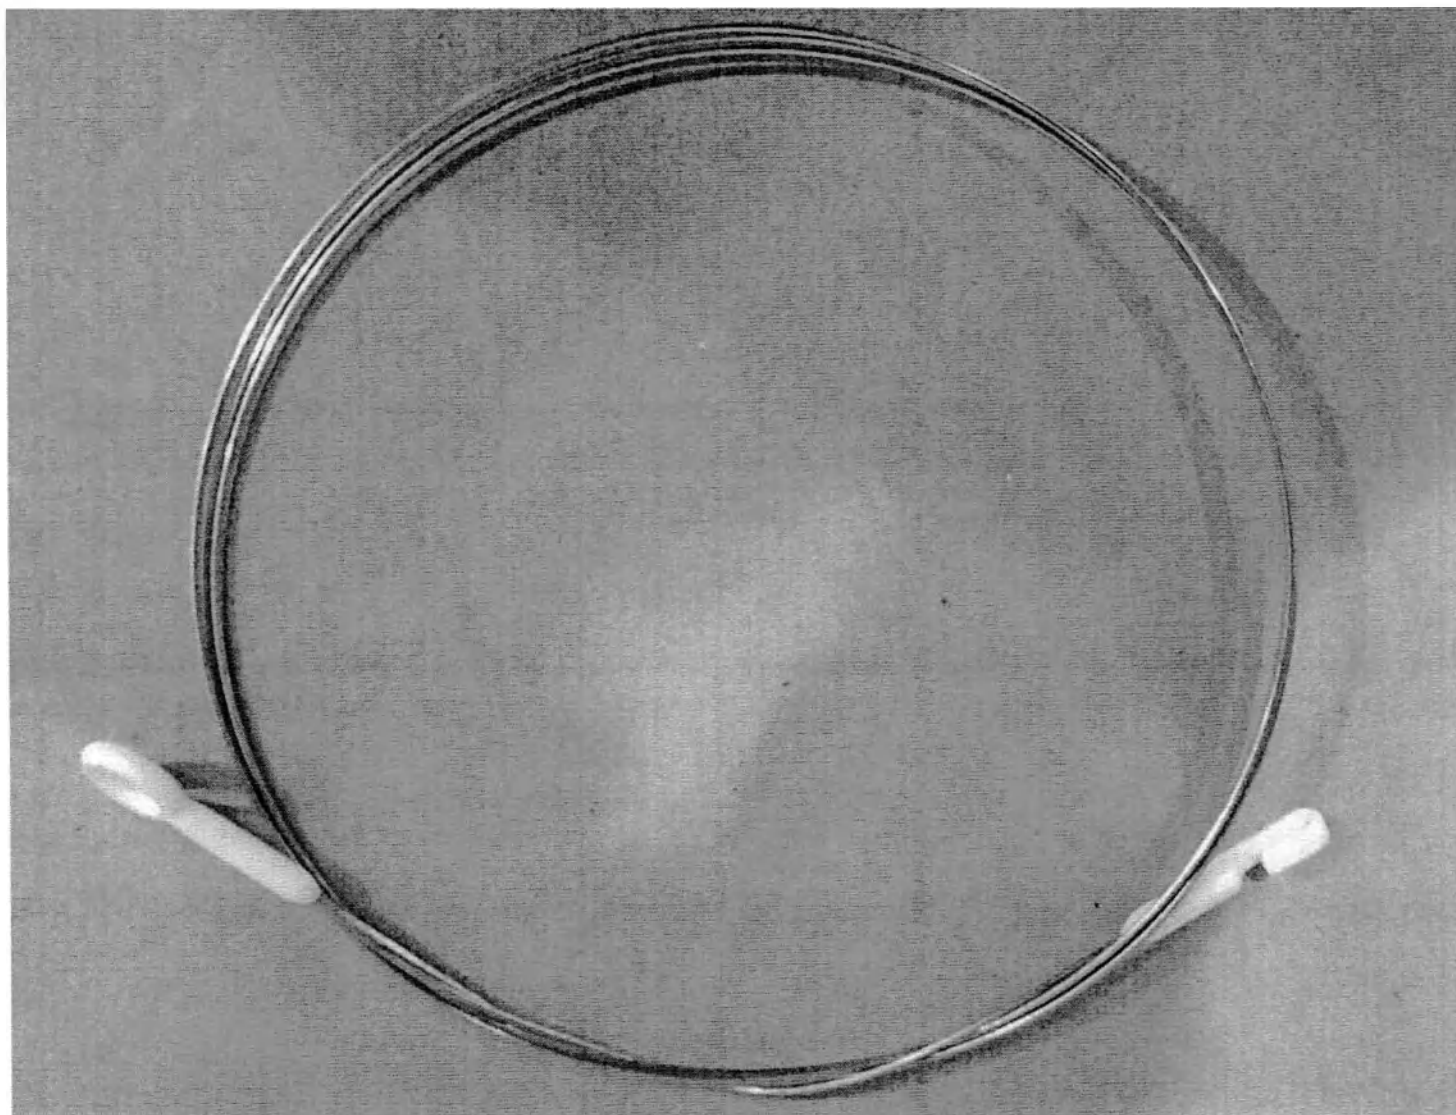


7.8 Струна, VH30H160, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.), в составе Комплекта дыхательного контура многоразовый TECH.233015, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




8 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: RT105 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

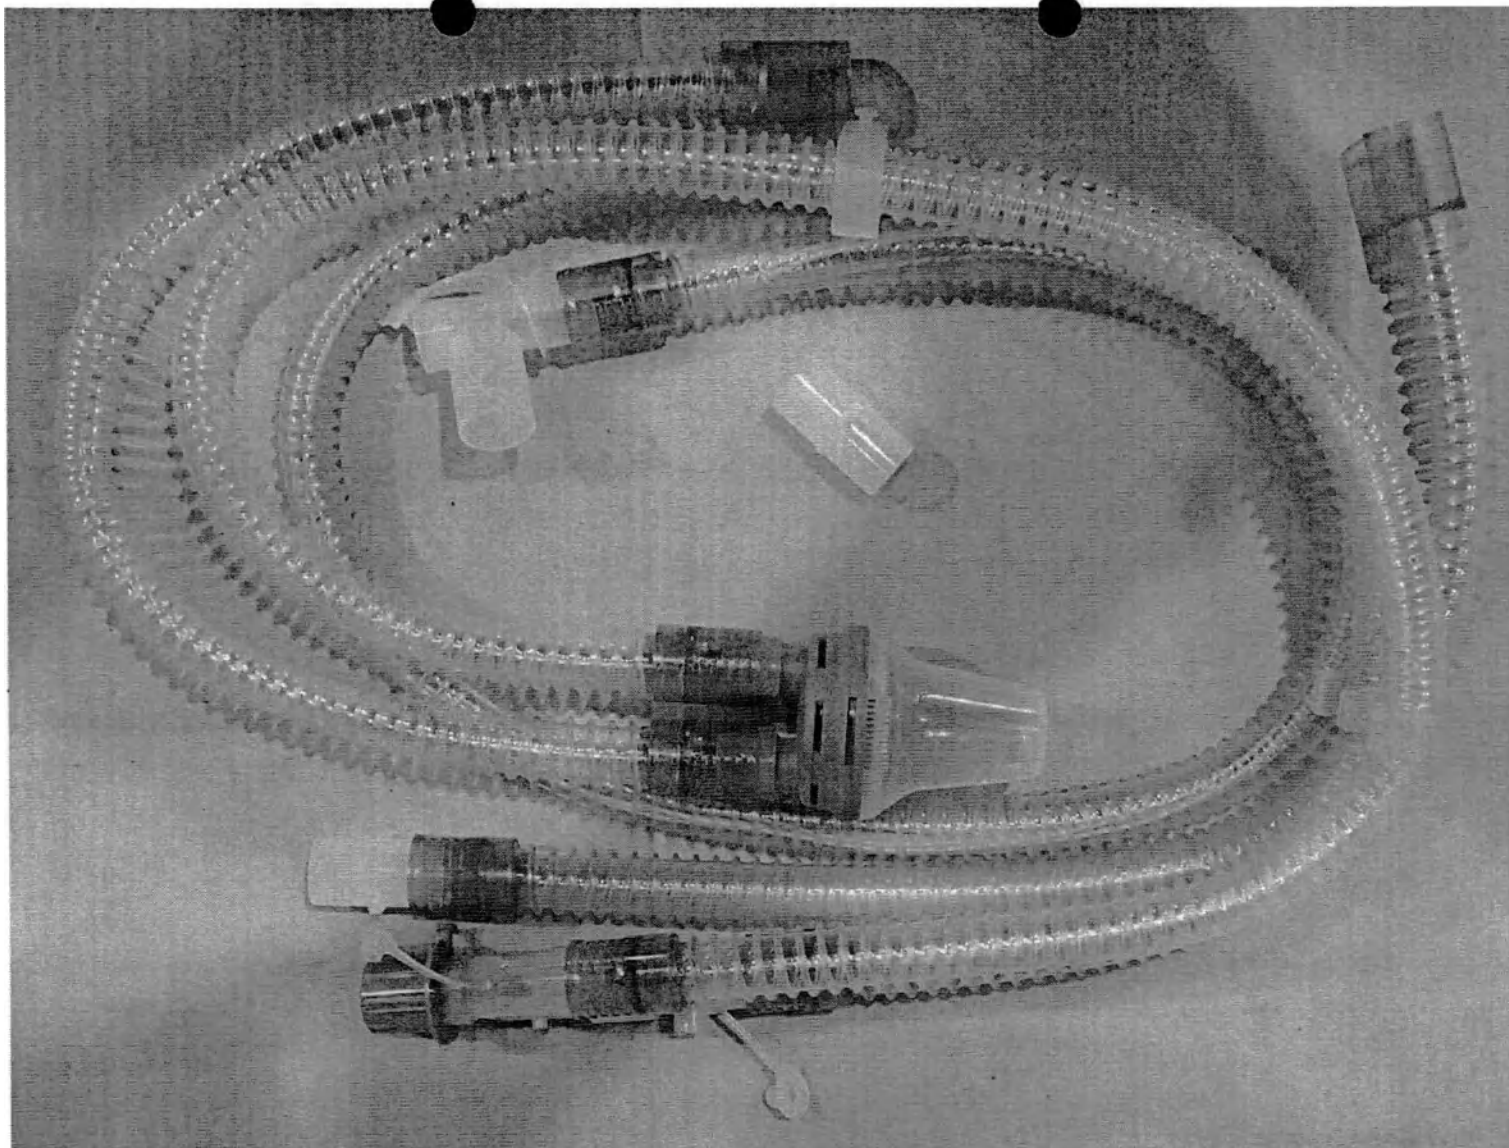


8 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для взрослых с обогревом с принадлежностями (при необходимости): шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосорбник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), 5025000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

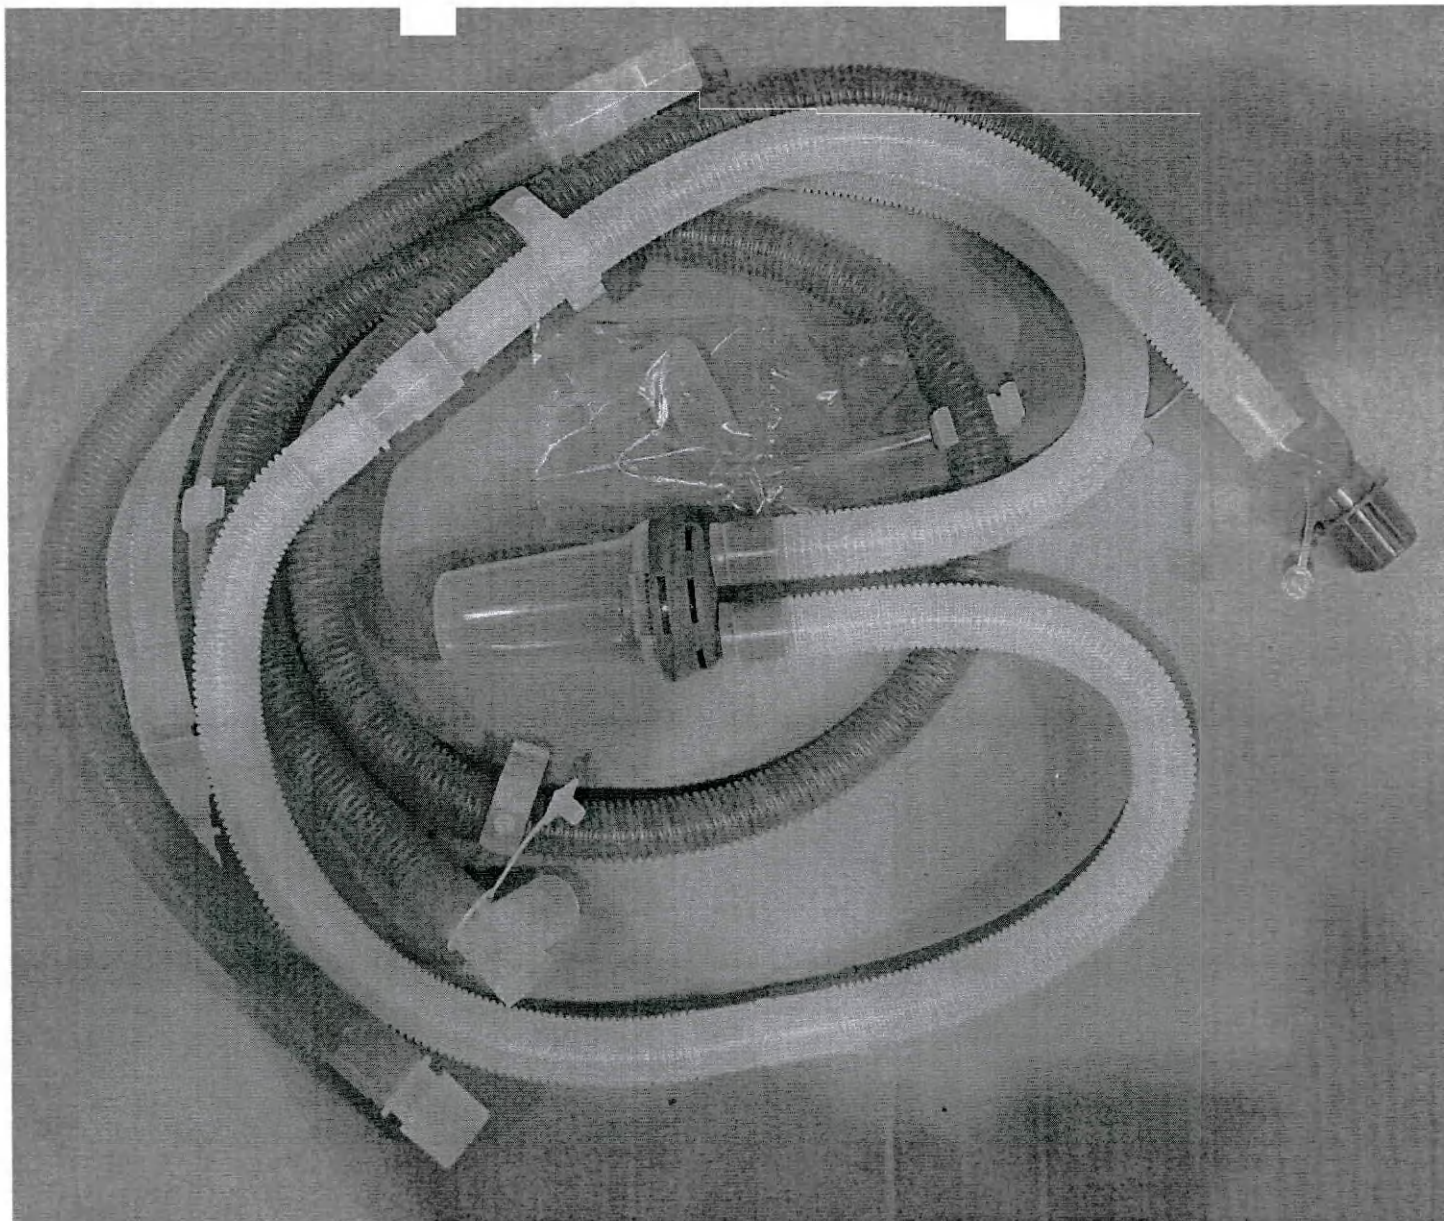


8 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для взрослых с обогревом с принадлежностями (при необходимости): шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), 2025000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

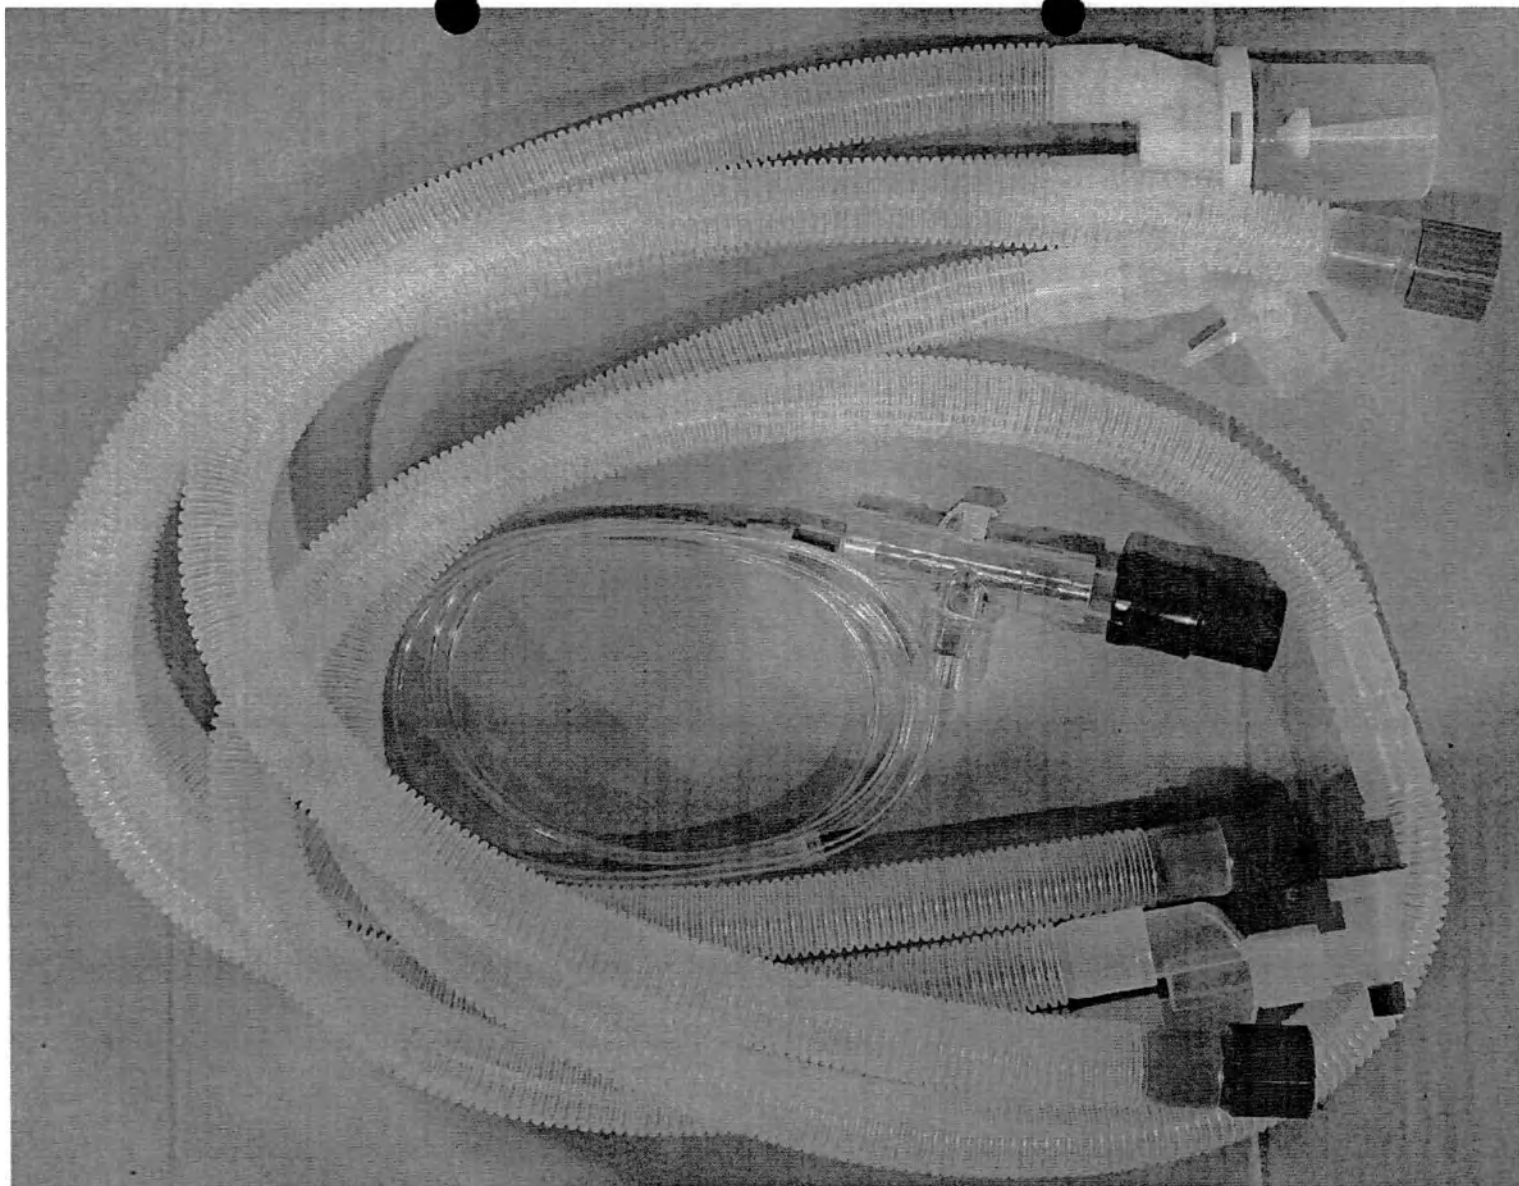


8 Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный для аппарата ИВЛ стандартный в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 4шт., угловой адаптер - 1шт., Т-коннектор - 1шт., влагосорбник - 1шт., трубка (0,8м) - 3шт., трубка (1,6м) - 1шт., трубка (2,0м) - 1шт., 3402Н, РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО "Ассомедика", Беларусь

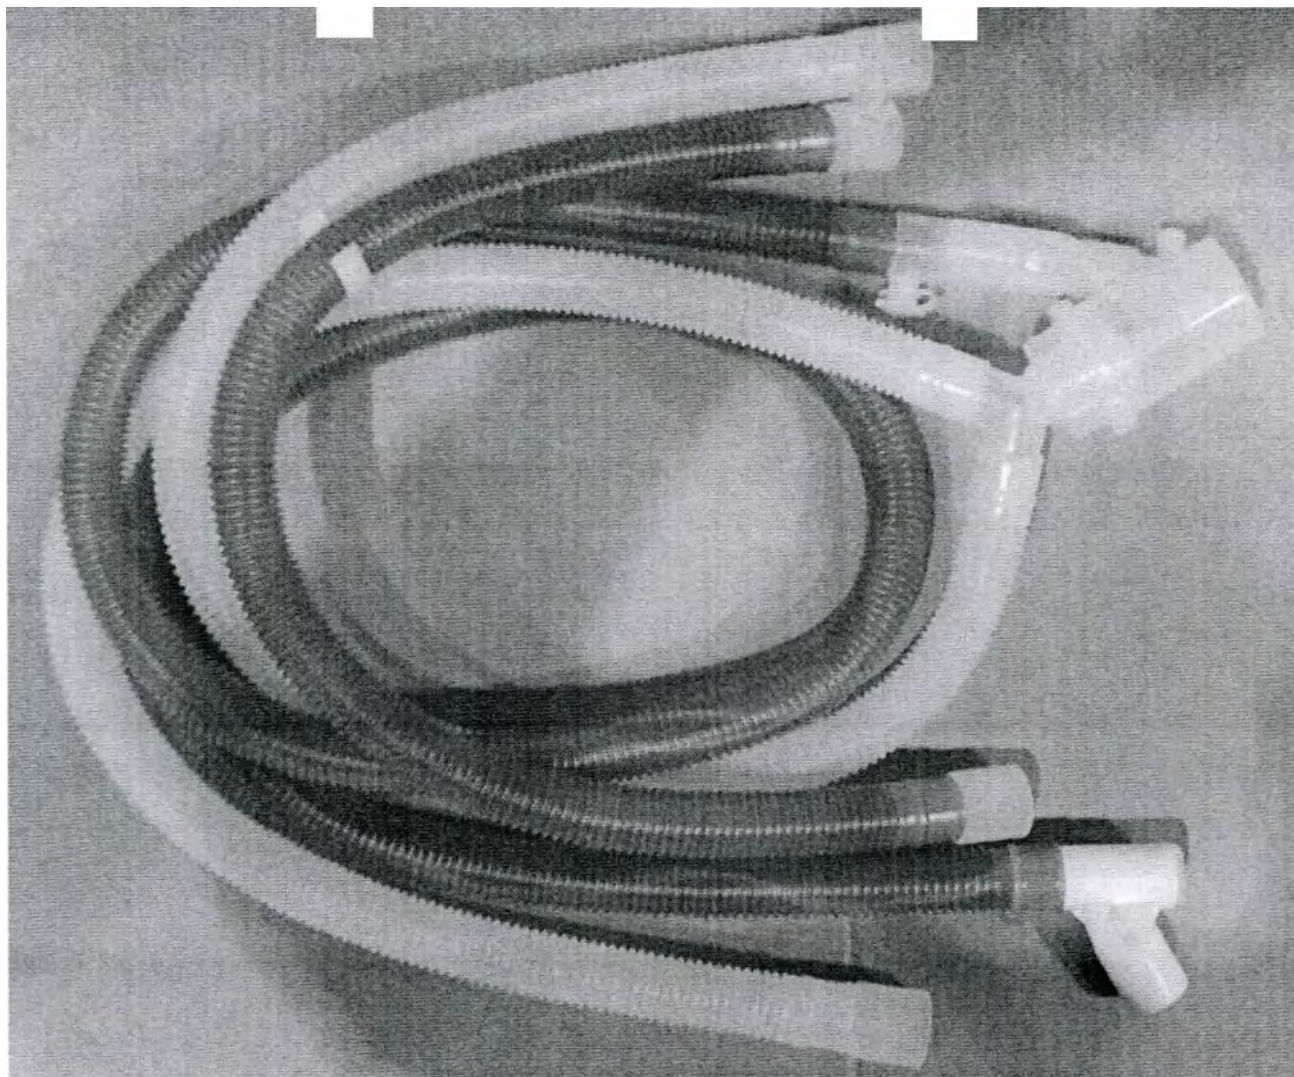


8 Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019, в вариантах исполнения: устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом (при необходимости), в составе: трубка гофрированная – 3 шт., трубка гофрированная обогреваемая - 1 шт., влагосборник – 1 шт., коннектор прямой - 5 шт., Y-образный коннектор - 1 шт., 207700040, РУ № РЗН 2020/10066, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия

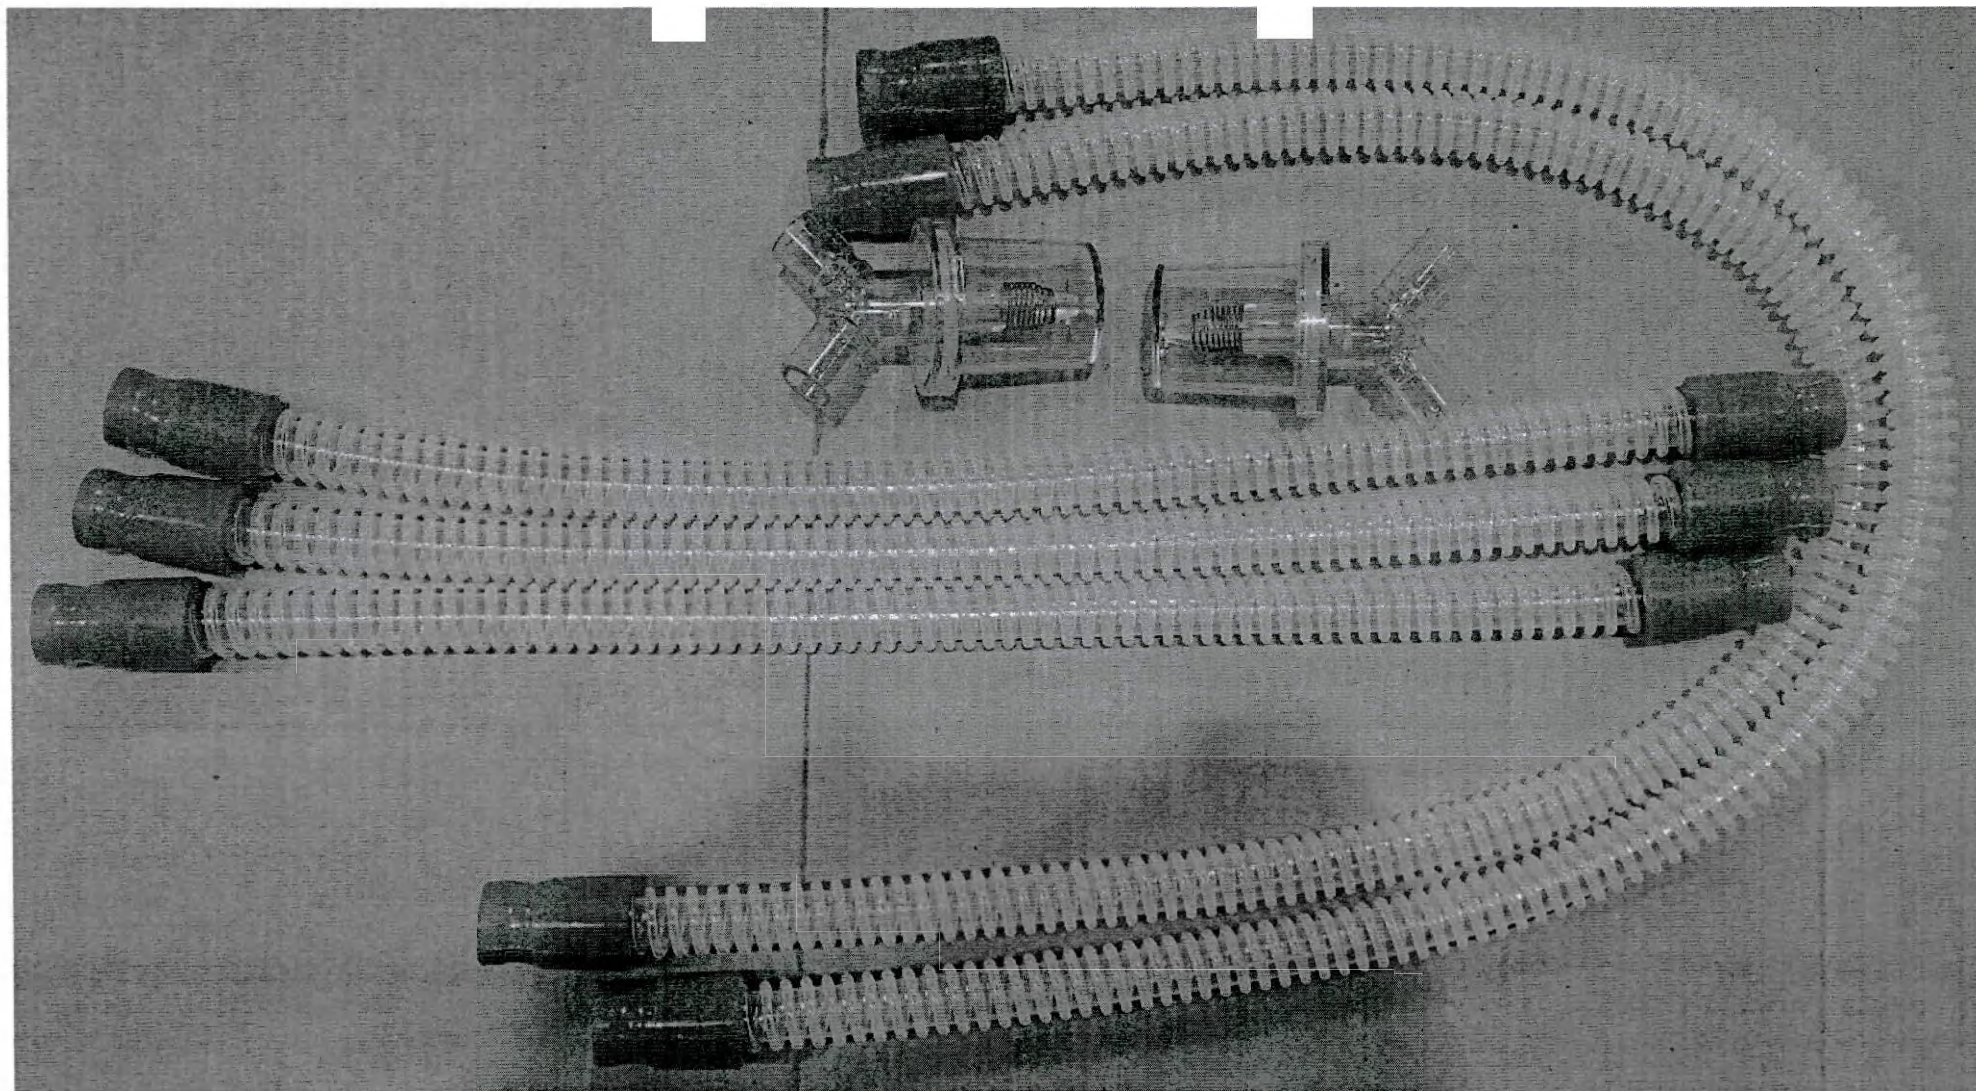


9 Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-"МС-1", РУ
№ ФСР 2010/07116, ООО «Медсиликон», Россия

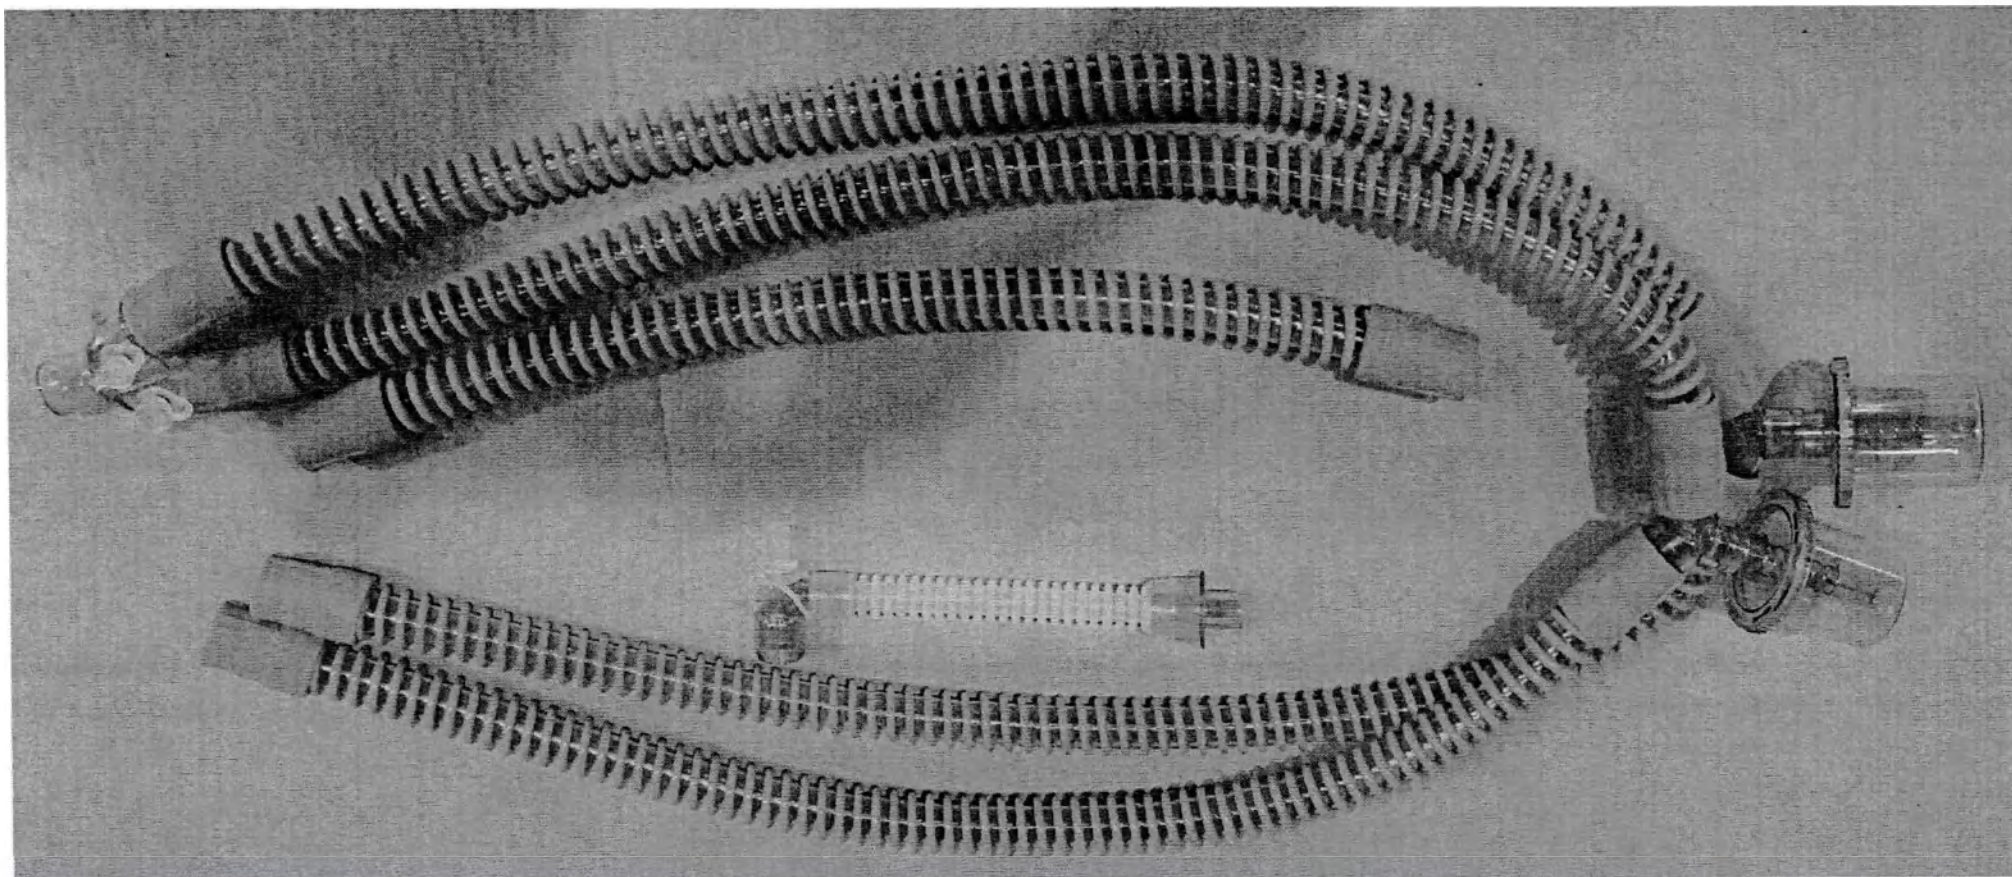


10 Контур дыхательный детский многоходовый, 662-202-PBE, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

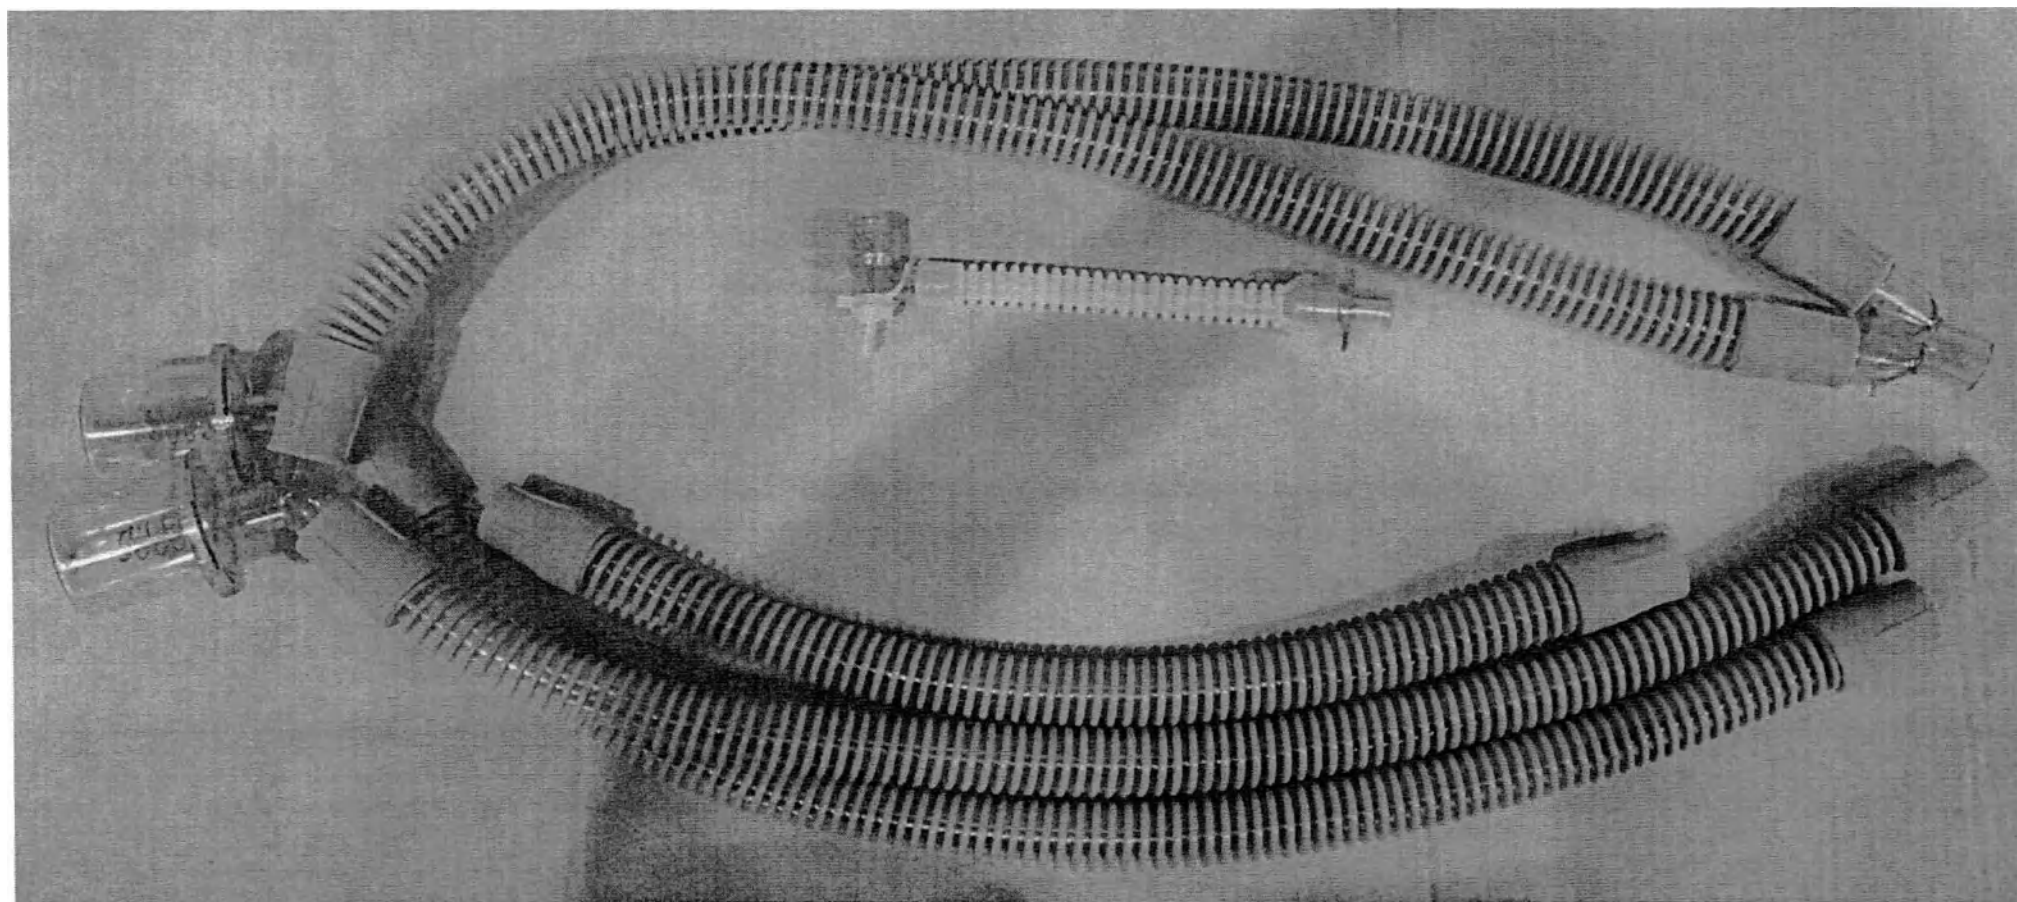


11 Контур дыхательный взрослый многоразовый, 663-202-ABE, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

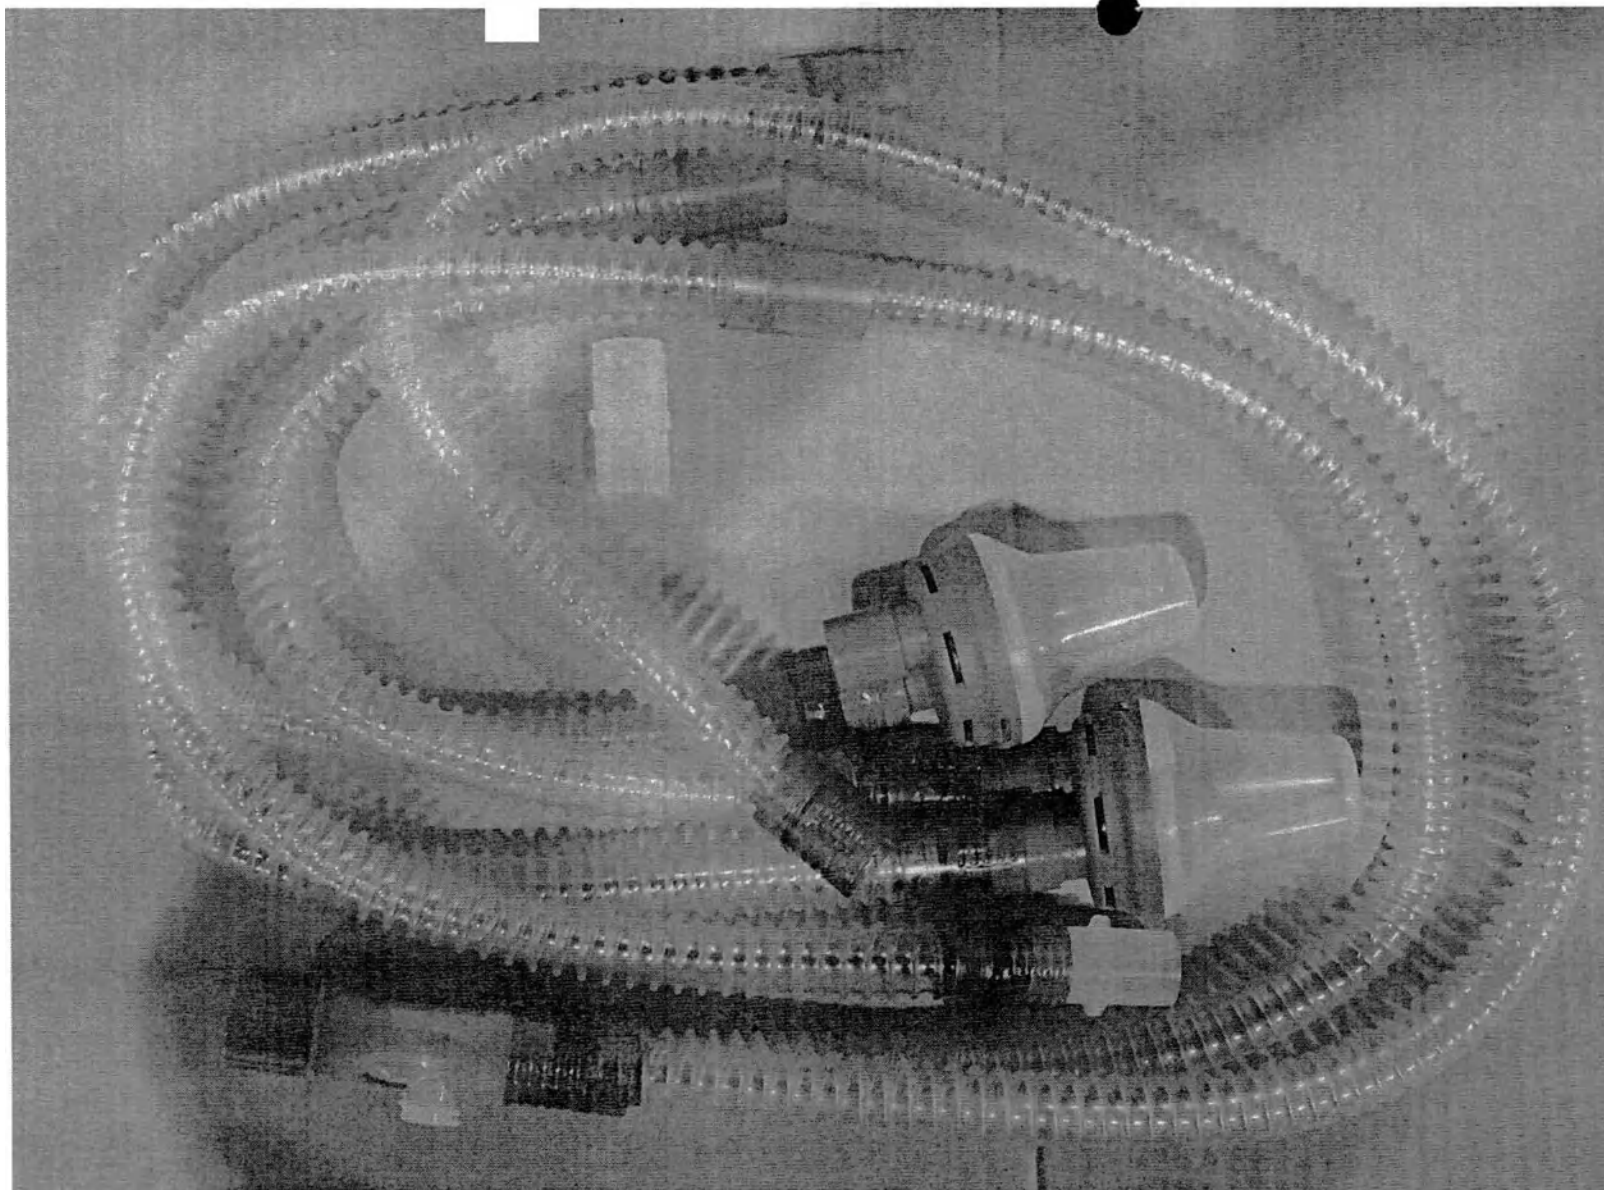


12 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для взрослых без обогрева, 5009000, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборники (до 2 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

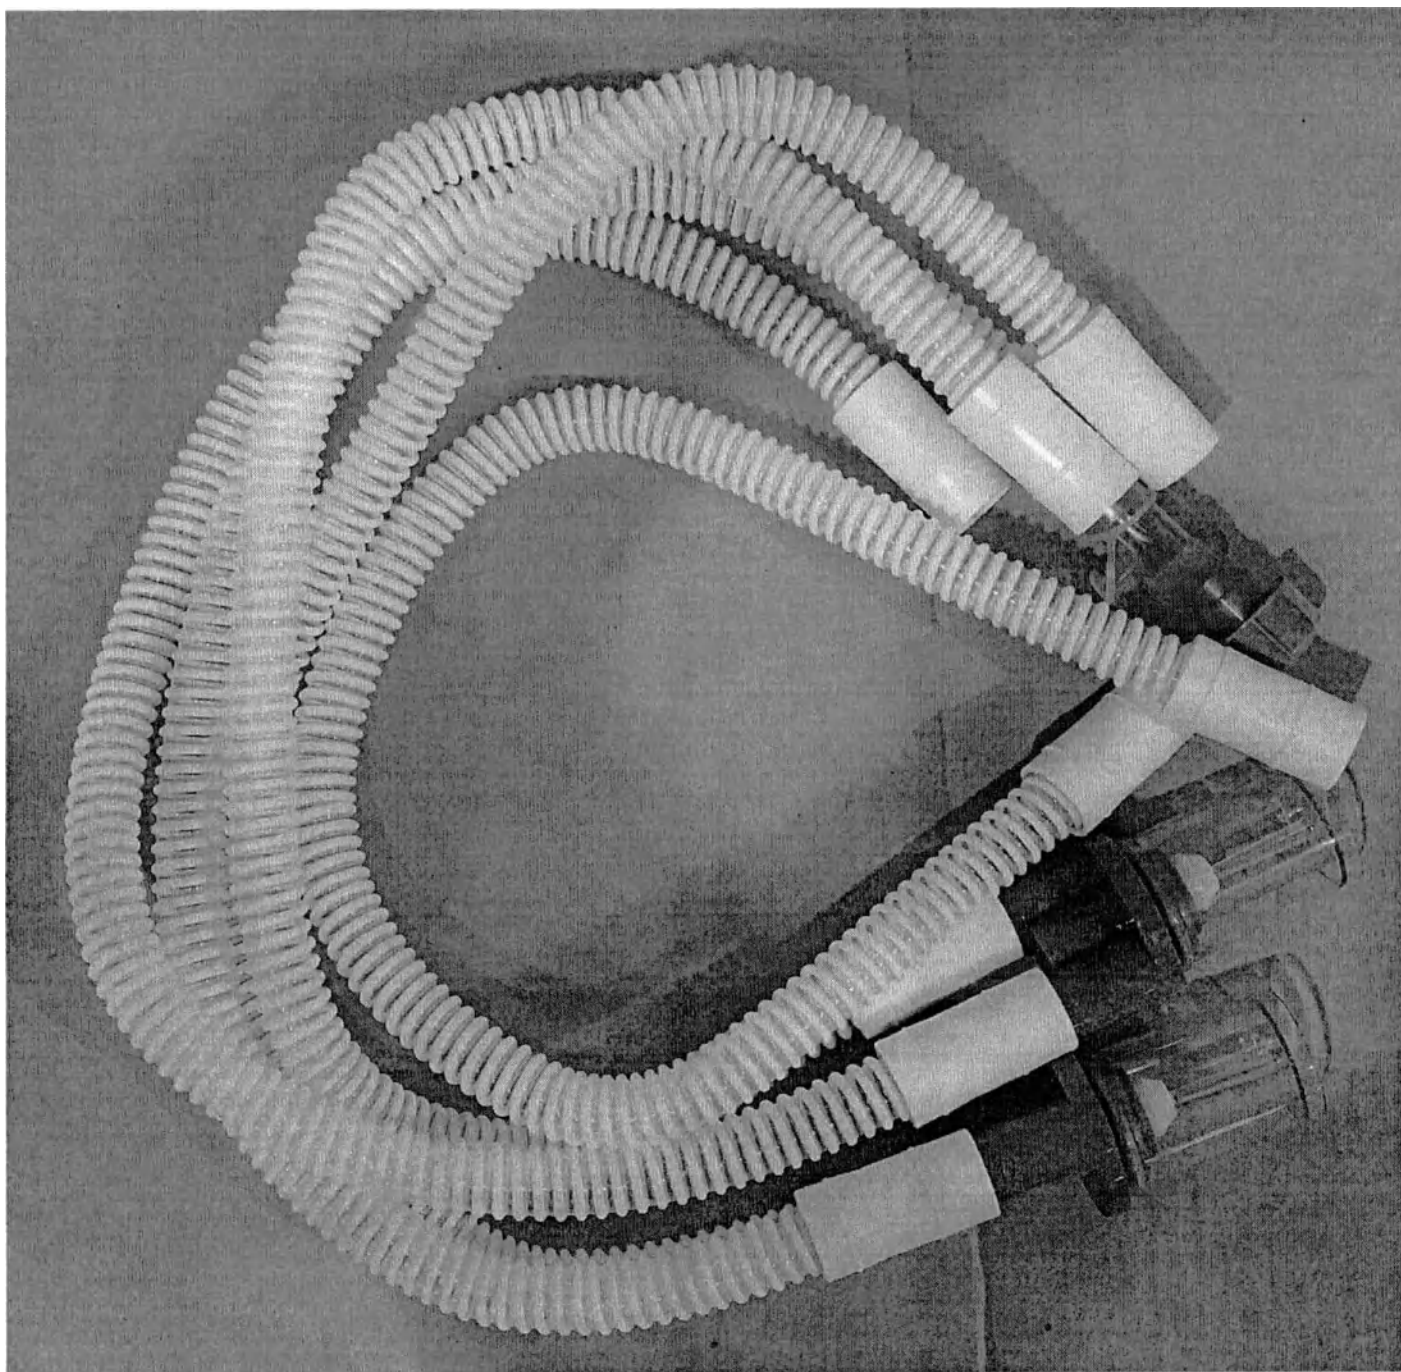


12 Контур дыхательный взрослый одноразовый, 038-01-155В, Gentec (Shanghai) Corporation, КНР

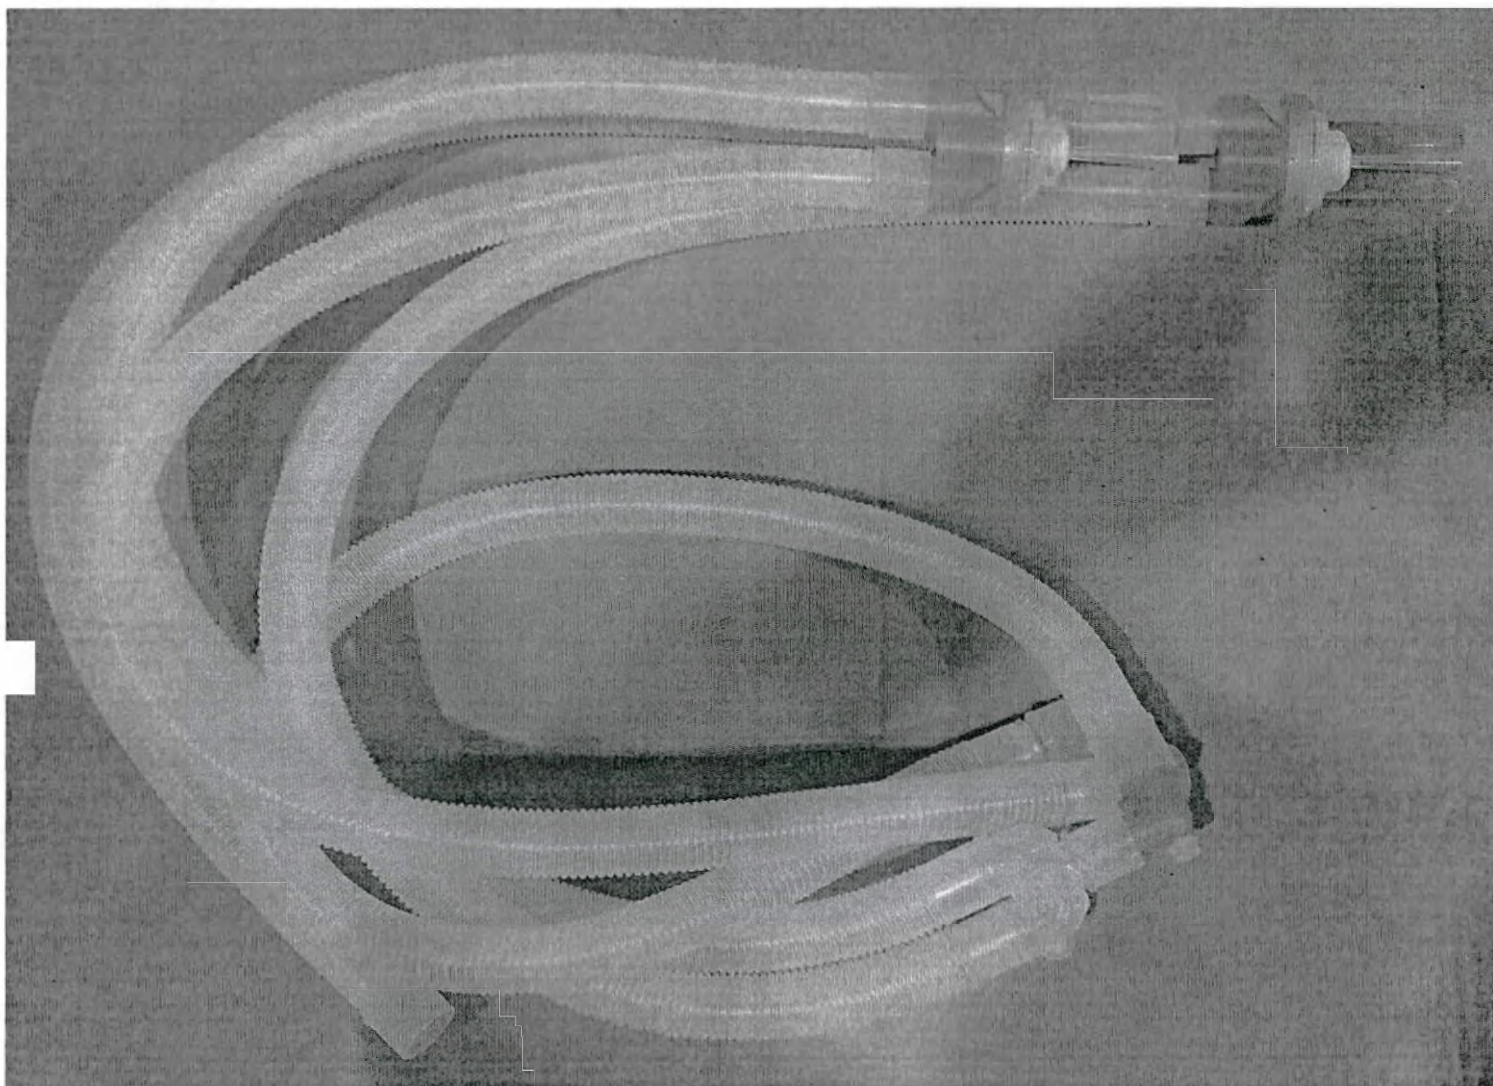


12. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019, в вариантах исполнения: устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, 2069028, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, в составе: трубка гофрированная - 5 шт., коннектор прямой - 10 шт., Y-образный коннектор - 1 шт., влагосборник – 2 шт., соединитель – 1 шт., РУ № РЗН 2020/10066, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия

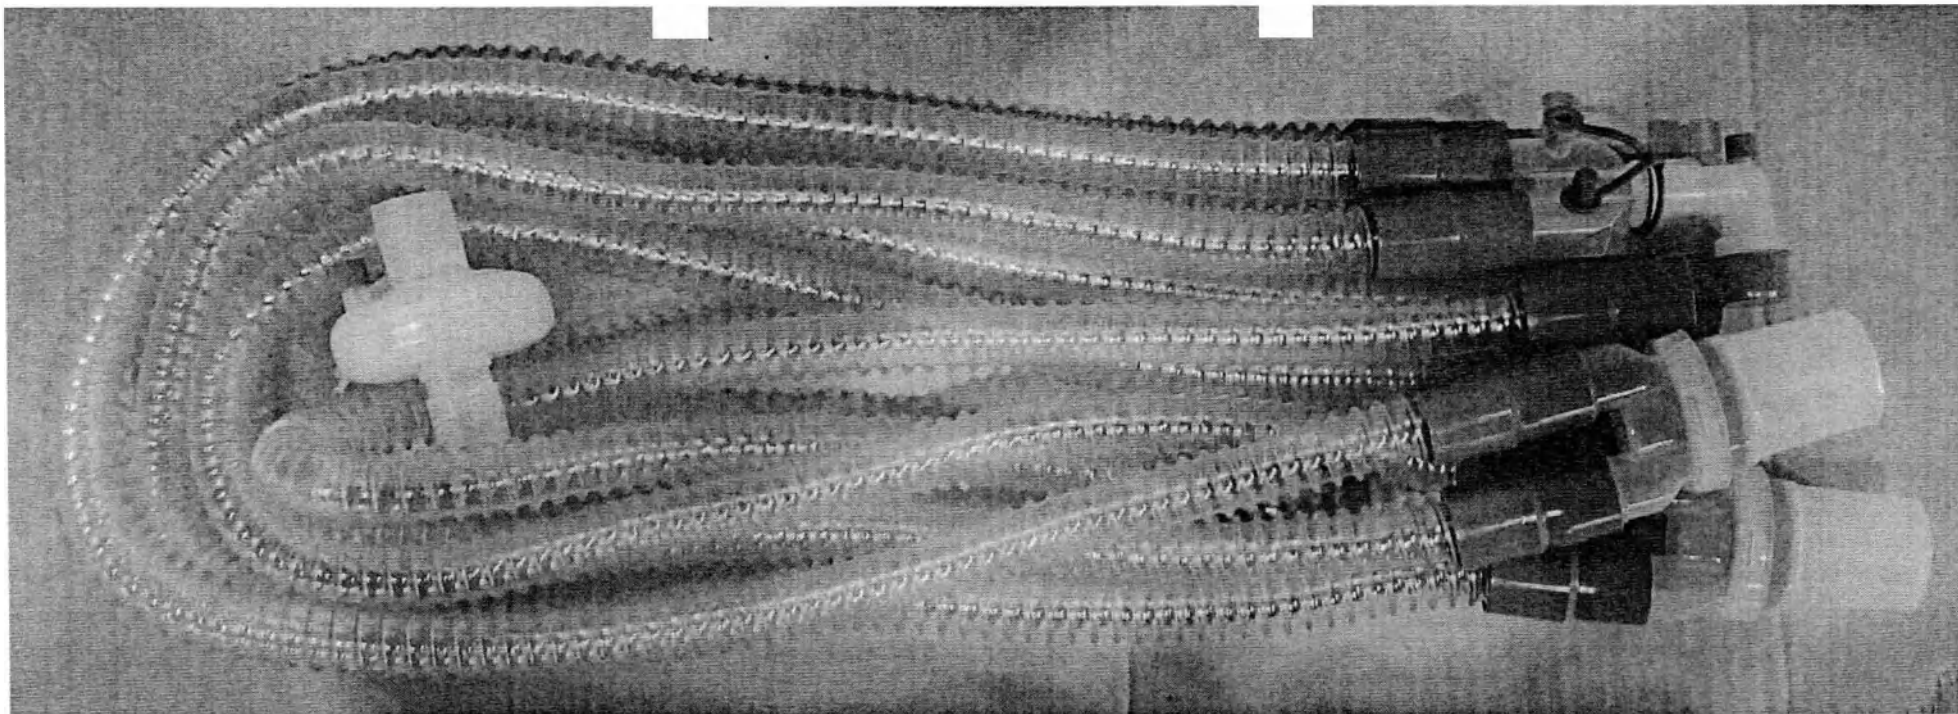


12 Контур дыхательный однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, 3504Г, вариант исполнения: контур дыхательный специальный в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 4шт., угловой адаптер – 1шт., влагосборник – 2шт., фильтр – 1 шт., трубка (0,8м) – 1шт., трубка (1,0м) – 4шт., РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО «Ассомедика», Беларусь

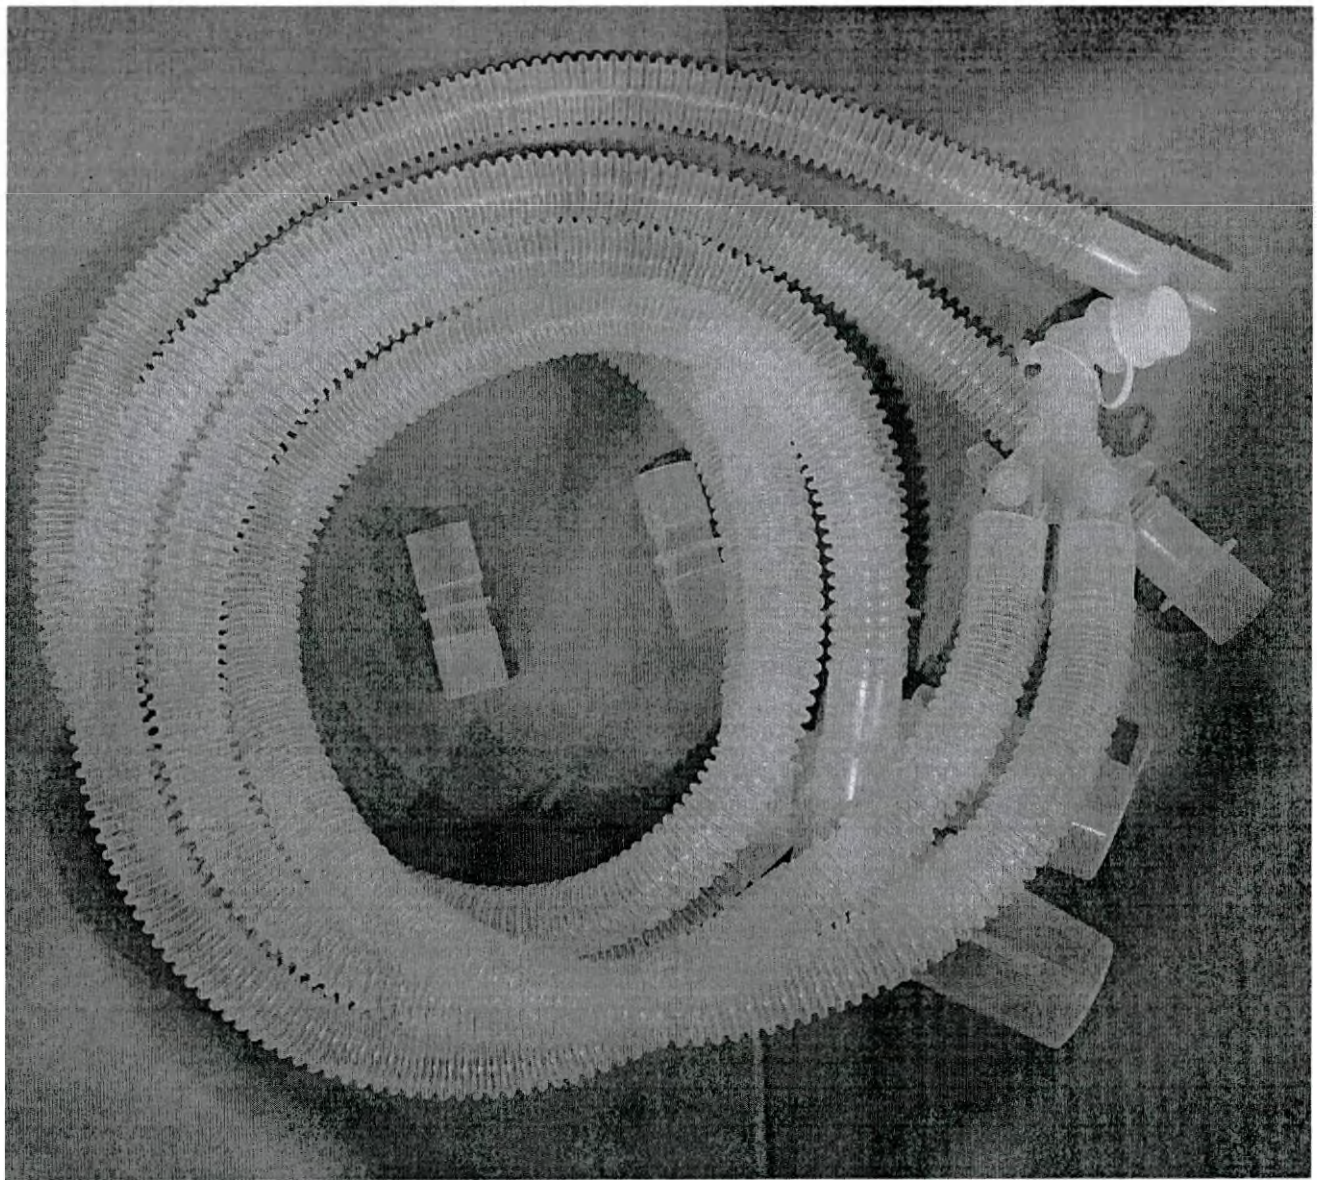


12 Контур медицинский дыхательный одноразового применения не стерильный по ТУ 32.50.21-001-03741033-021, в вариантах исполнения: комплект контура дыхательного для взрослых, АЕ1216001, в составе: Y-образный коннектор 22М-22М/15F22М с портами - 1 шт., трубка дыхательная 22 длиной 80 – 5 шт., коннекторы (жесткие, угловые, с дополнительными портами), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - 1 шт., коннектор прямой: 22М-22М/15F – 2 шт., коннектор прямой: 22М-22F – 4 шт., колпачок тестовый (защитный) 22F – 1 шт., влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 – 2 шт., РУ № РЗН 2022/17667, ООО «Глобус»,
Россия

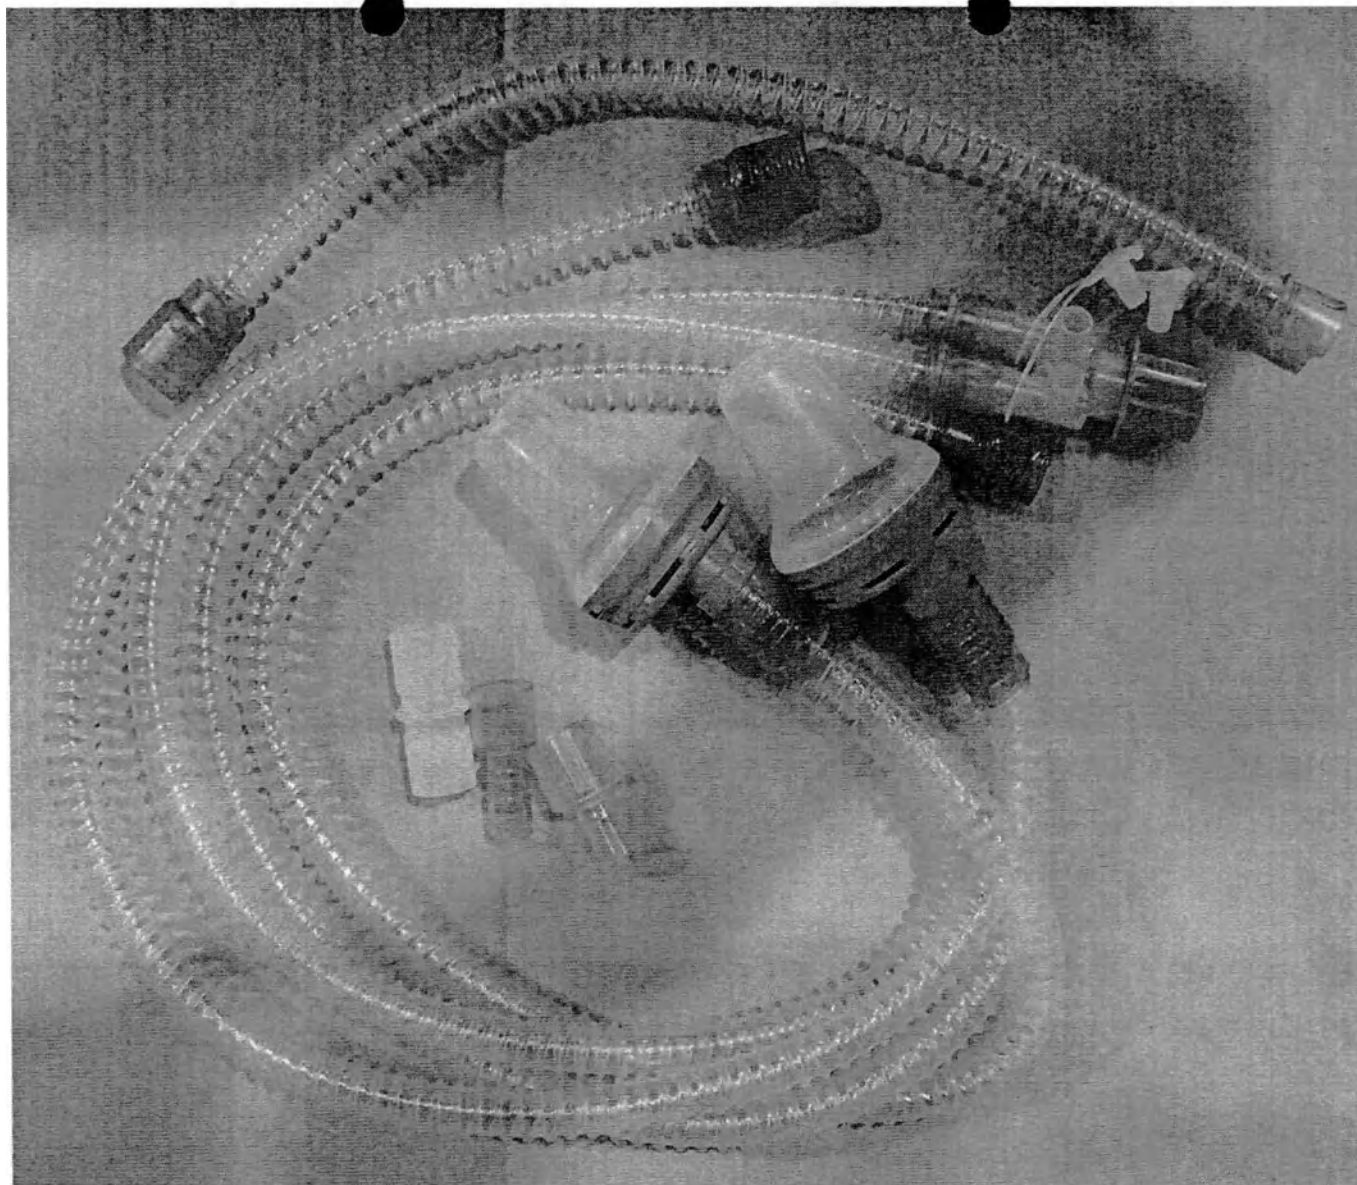


13 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для детей, 5513000, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборники (до 2 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

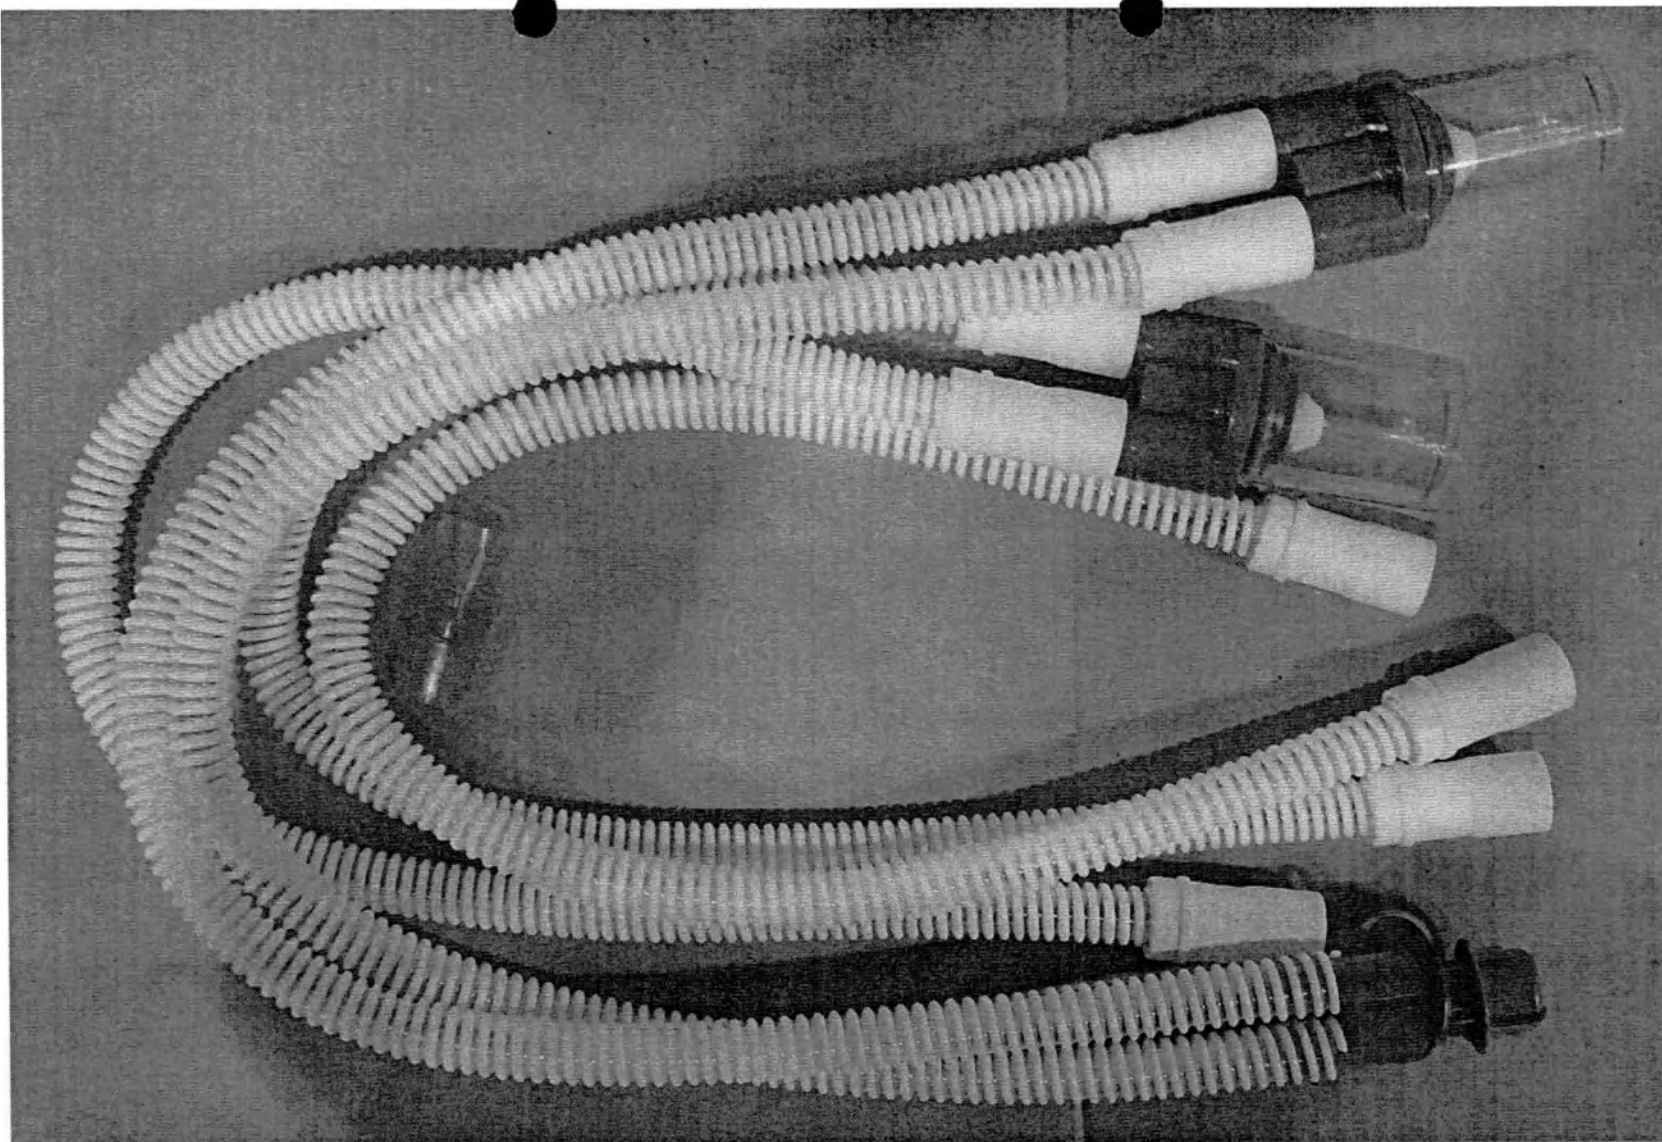


13 Контур дыхательный детский одноразовый, 038-02-155В, Flexicare Medical Limited, Великобритания

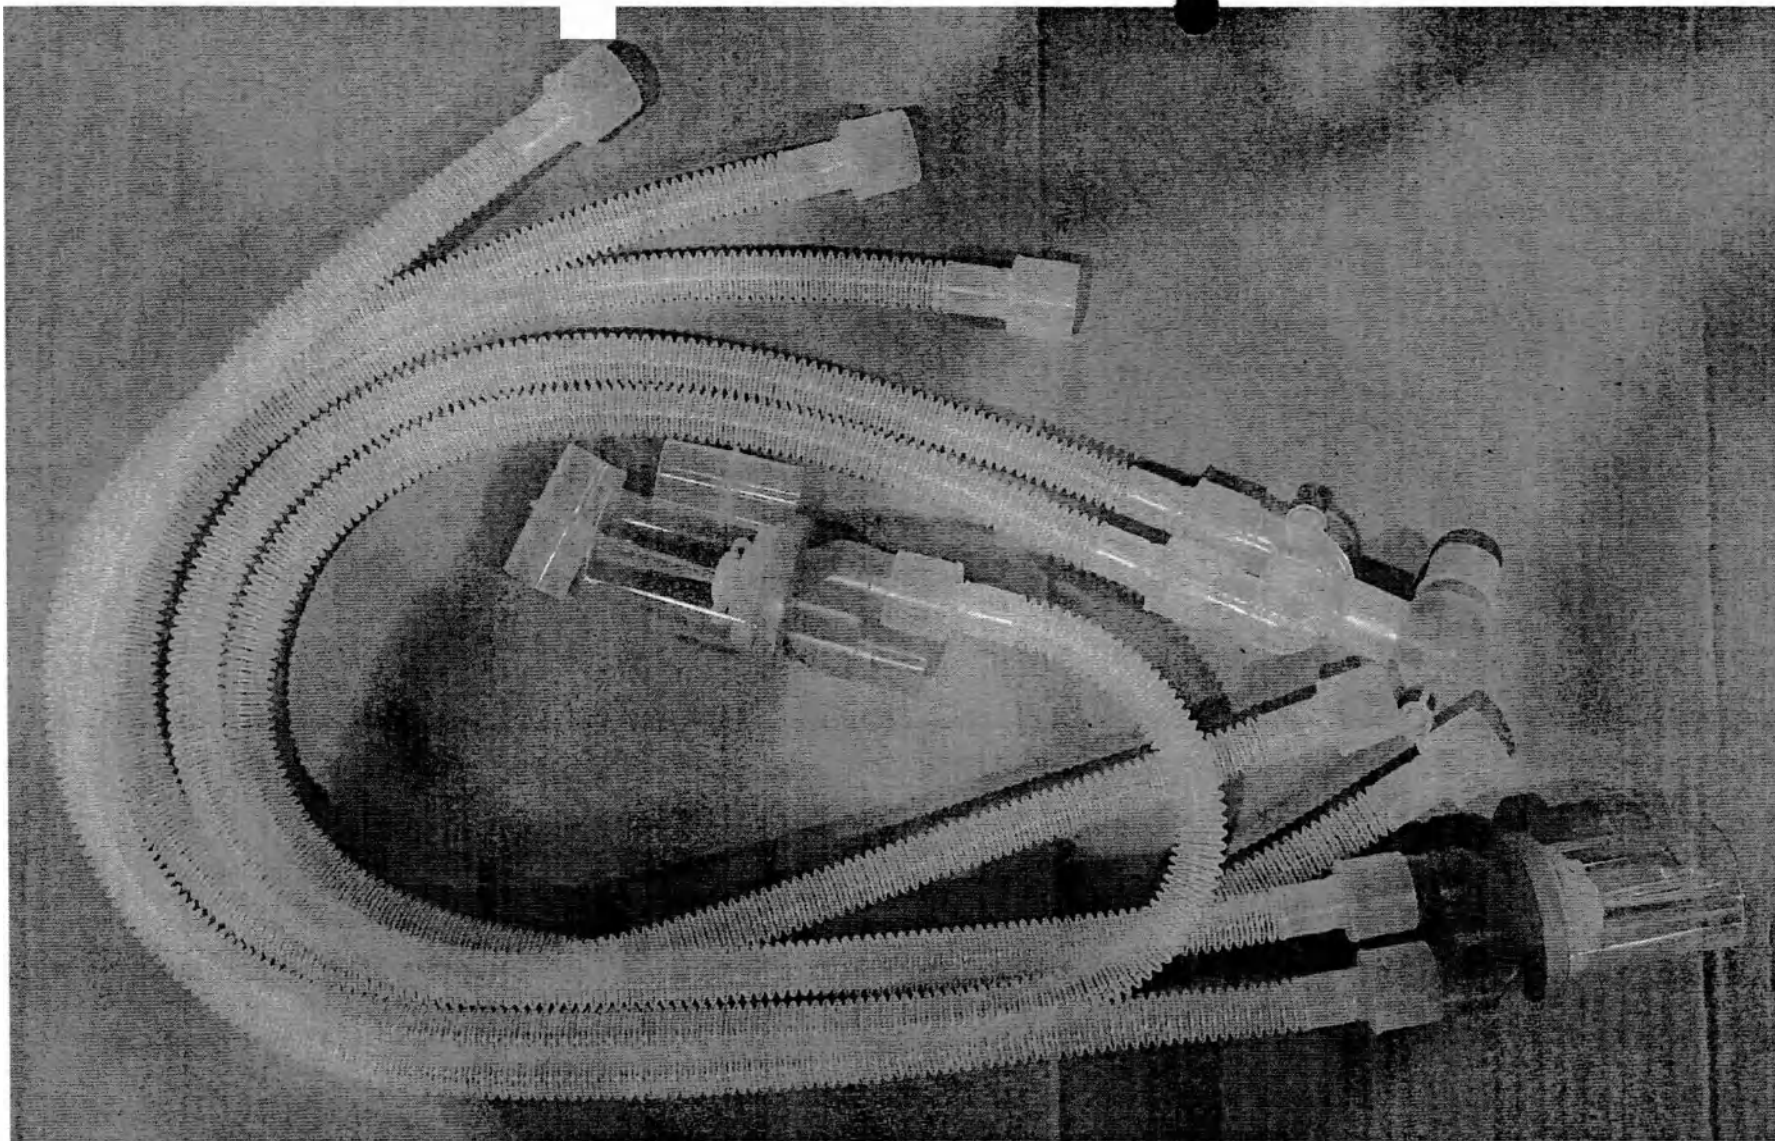


13 Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019, в вариантах исполнения: Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, 5069027, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, в составе: трубка гофрированная - 5 шт., коннектор прямой - 12 шт., Y-образный коннектор - 1 шт., влагосборник – 2 шт., соединитель – 1 шт., тест-колпачок защитный – 1 шт., РУ № РЗН 2020/10066, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия

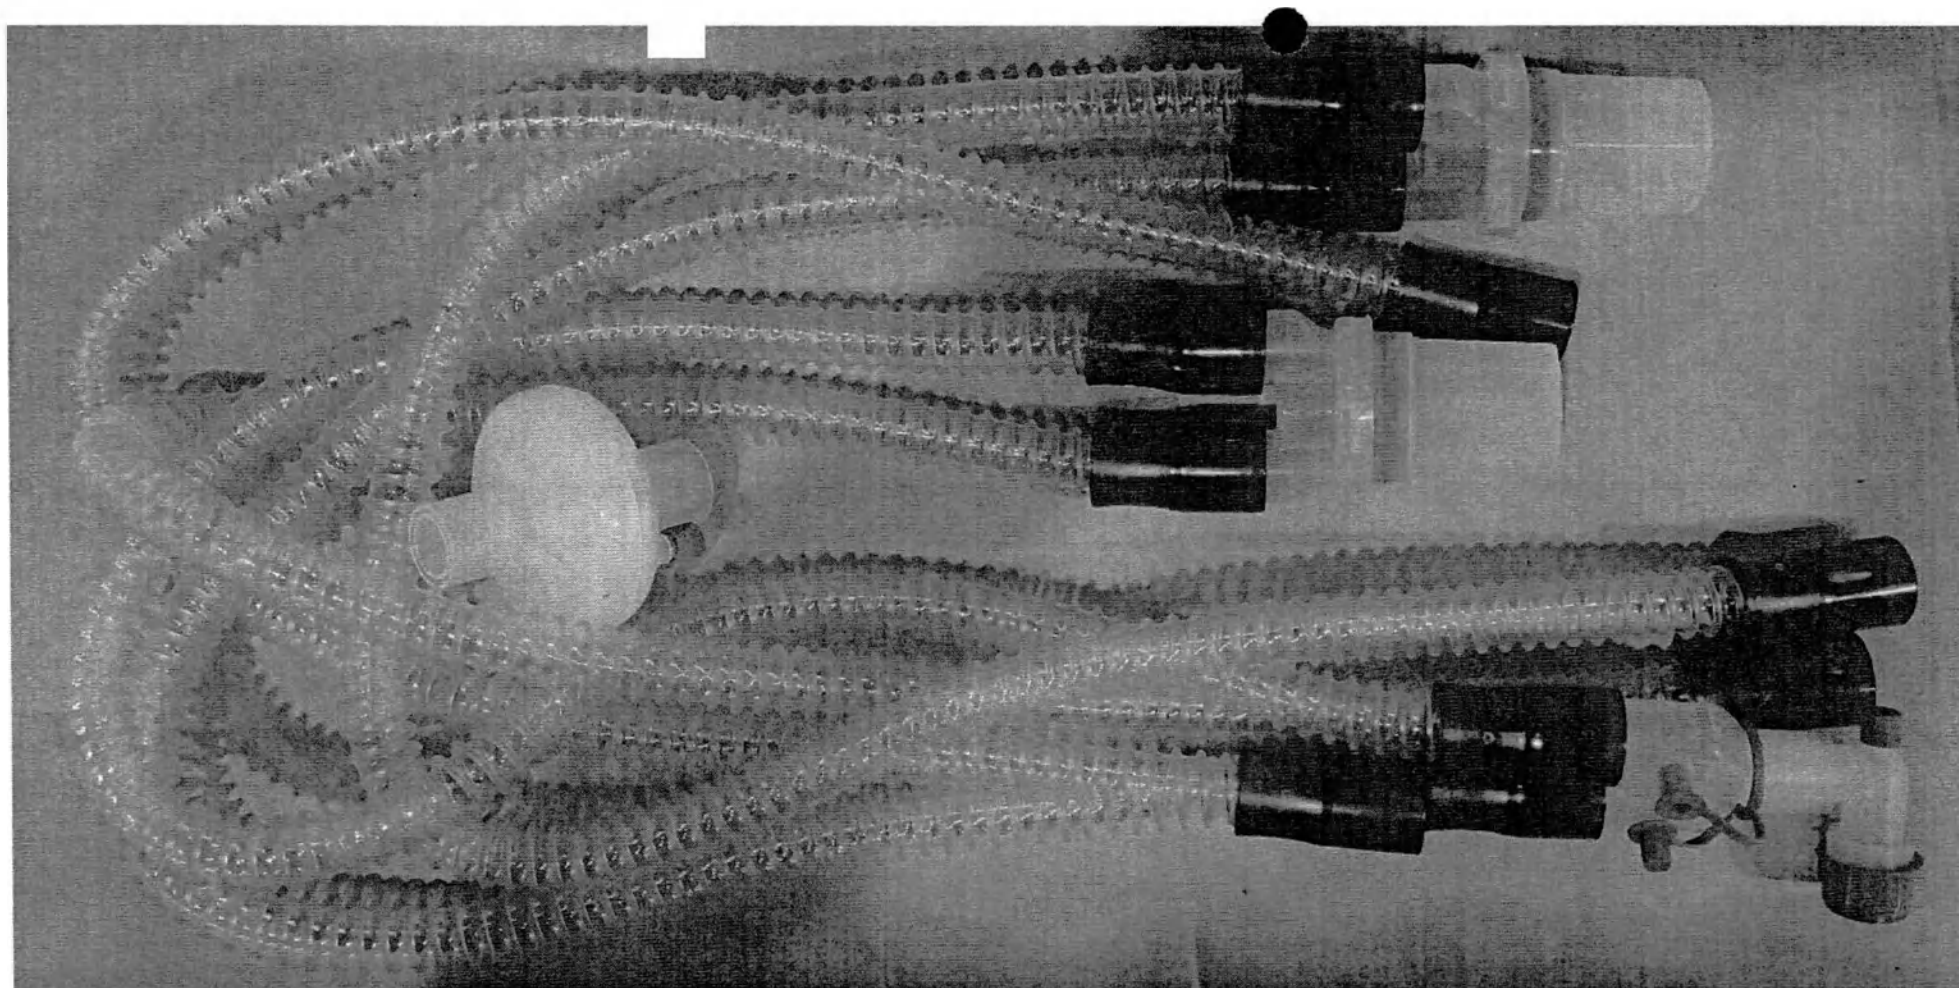


13 Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный специальный, 5704Г, в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 4шт., угловой адаптер – 1шт., влагосборник – 2шт., фильтр – 1 шт., трубка (0,8м) – 5шт., РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО «Ассомедика», Беларусь

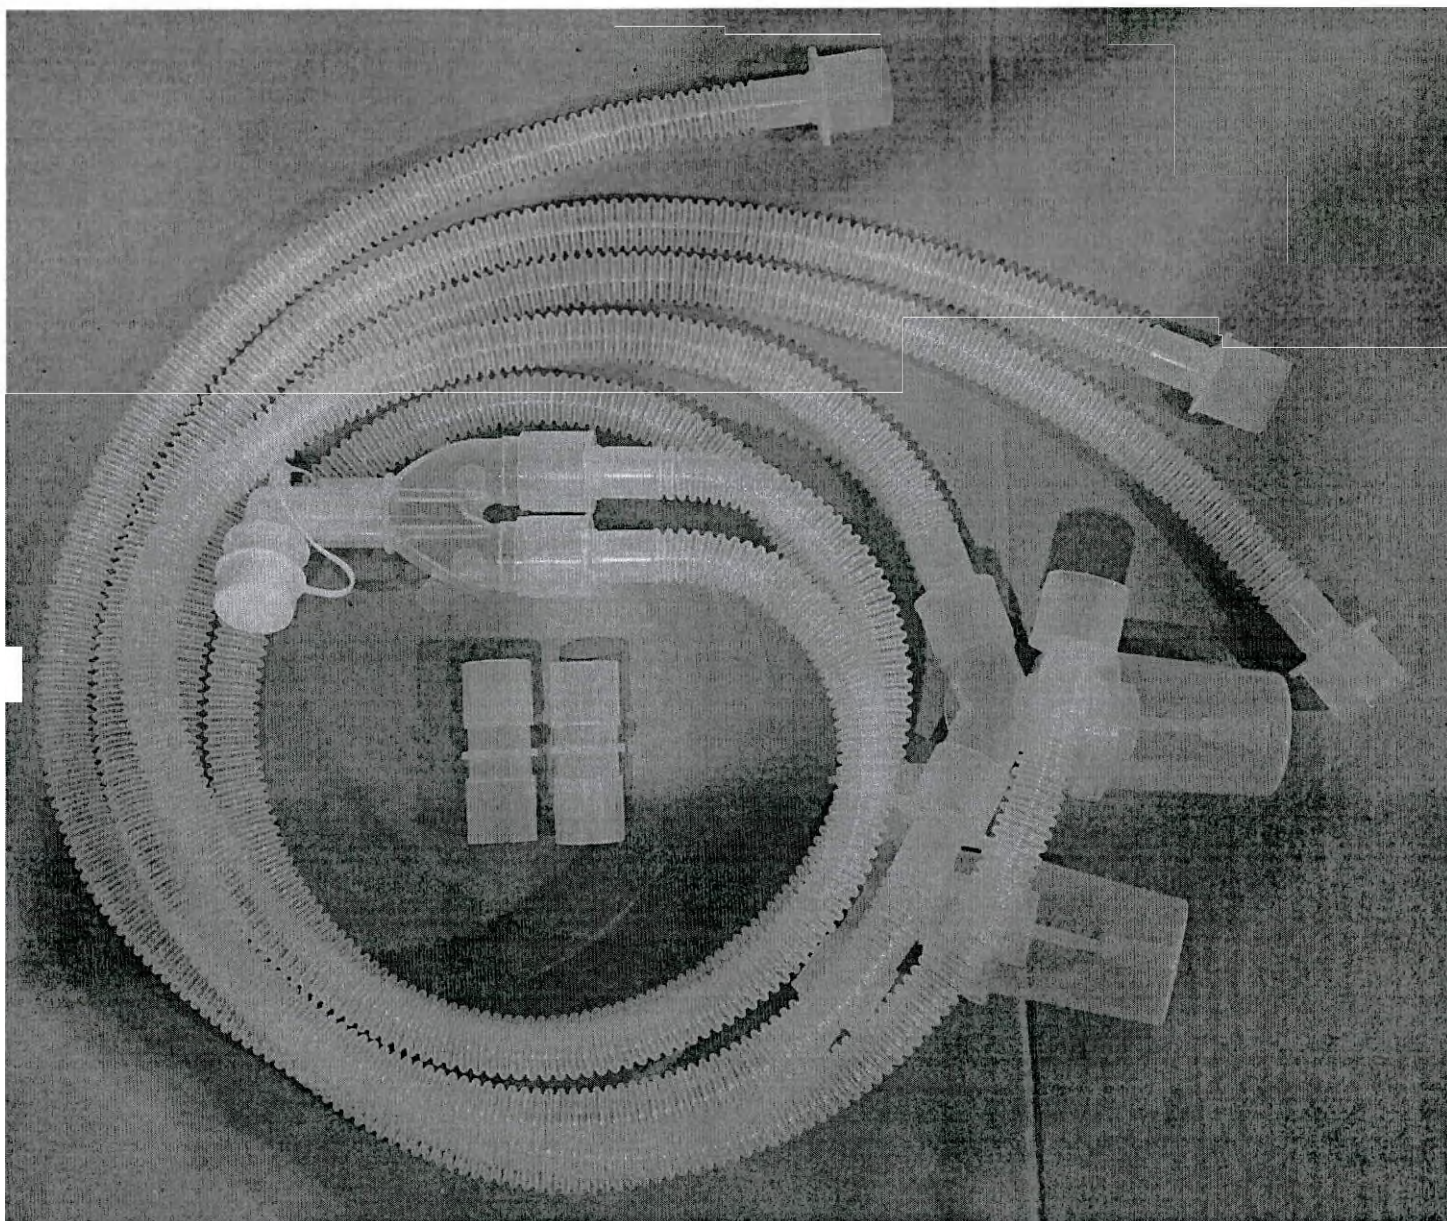


13 Контур медицинский дыхательный одноразового применения не стерильный по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021, в вариантах исполнения: комплект контура дыхательного для детей, АЕ3216000, в составе: Y-образный коннектор 22М-22М/15F22М с портами – 1 шт., трубка дыхательная 15 длиной 80 – 5 шт., коннекторы (жесткие, угловые с дополнительными портами) производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 – 1 шт., коннектор прямой: размер 22М-22F – 6 шт., колпачок тестовый (защитный) 22F – 1 шт., влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566, РУ № РЗН 2022/17667, ООО «Глобус», Россия

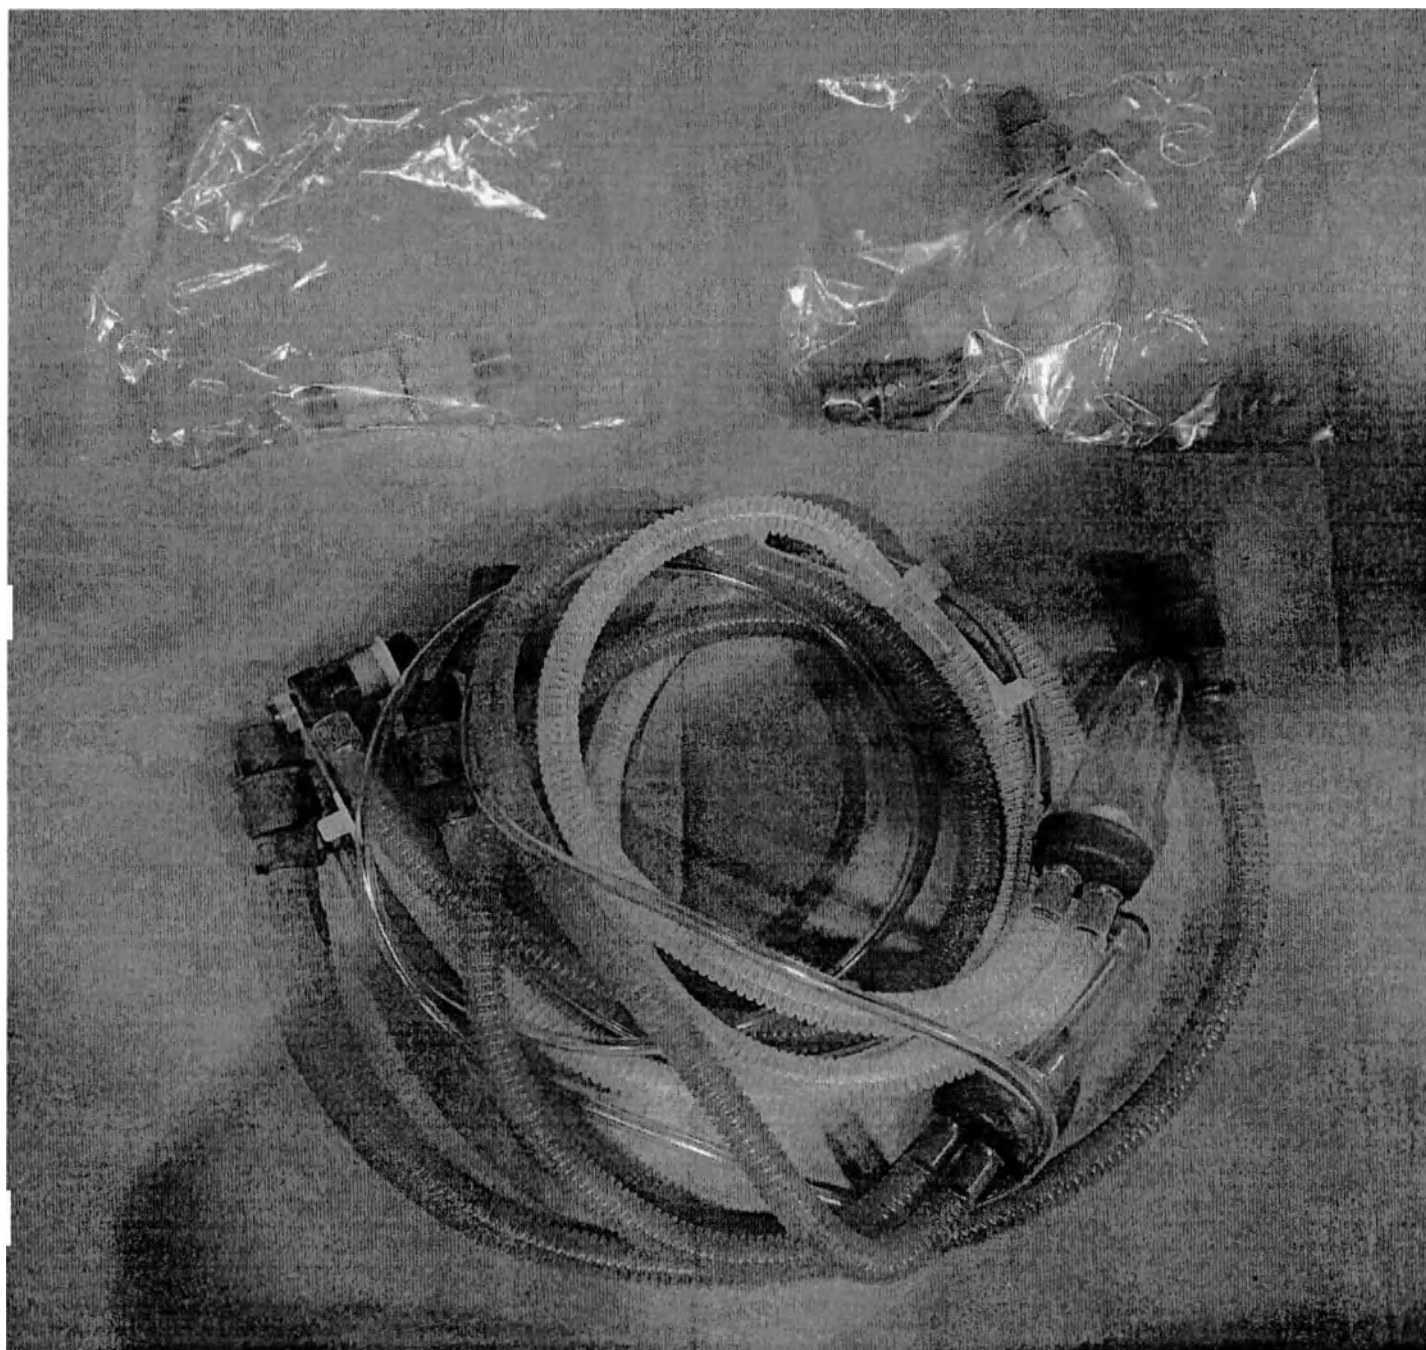


14 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для новорожденных, 4510000, с принадлежностями (при необходимости): шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборники (до 2 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

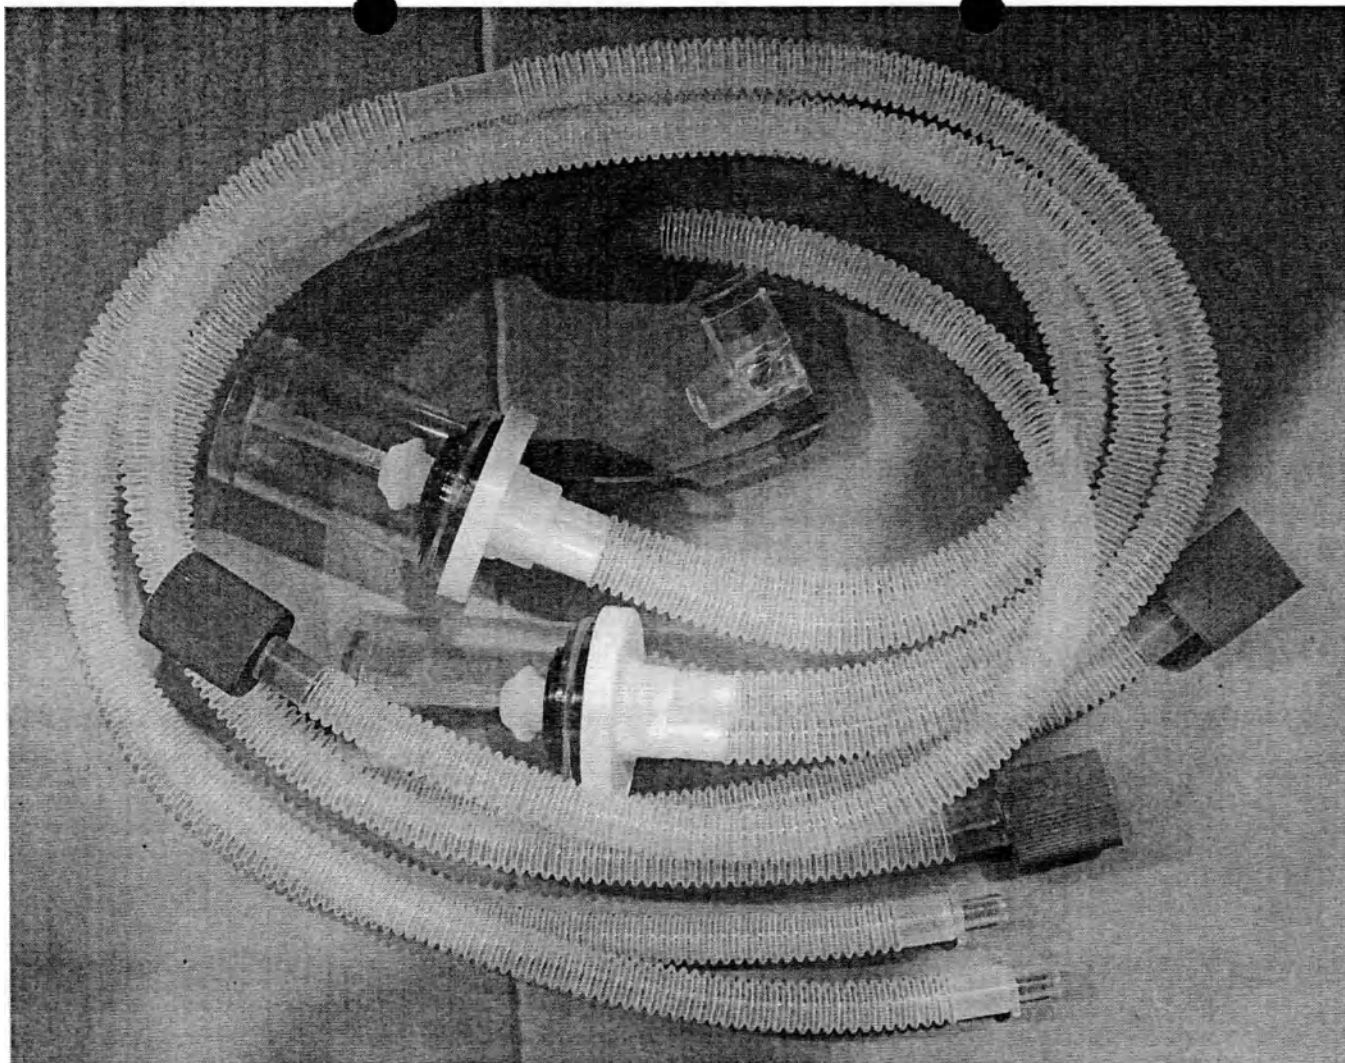


14 Контурь дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный специальный, 6603Н, в составе: У-адаптор – 1 шт., прямой адаптер – 4 шт., влагосборник – 2 шт., трубка (0,4м) – 1 шт., трубка (0,8м) – 4 шт., РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО «Ассомедика», Беларусь

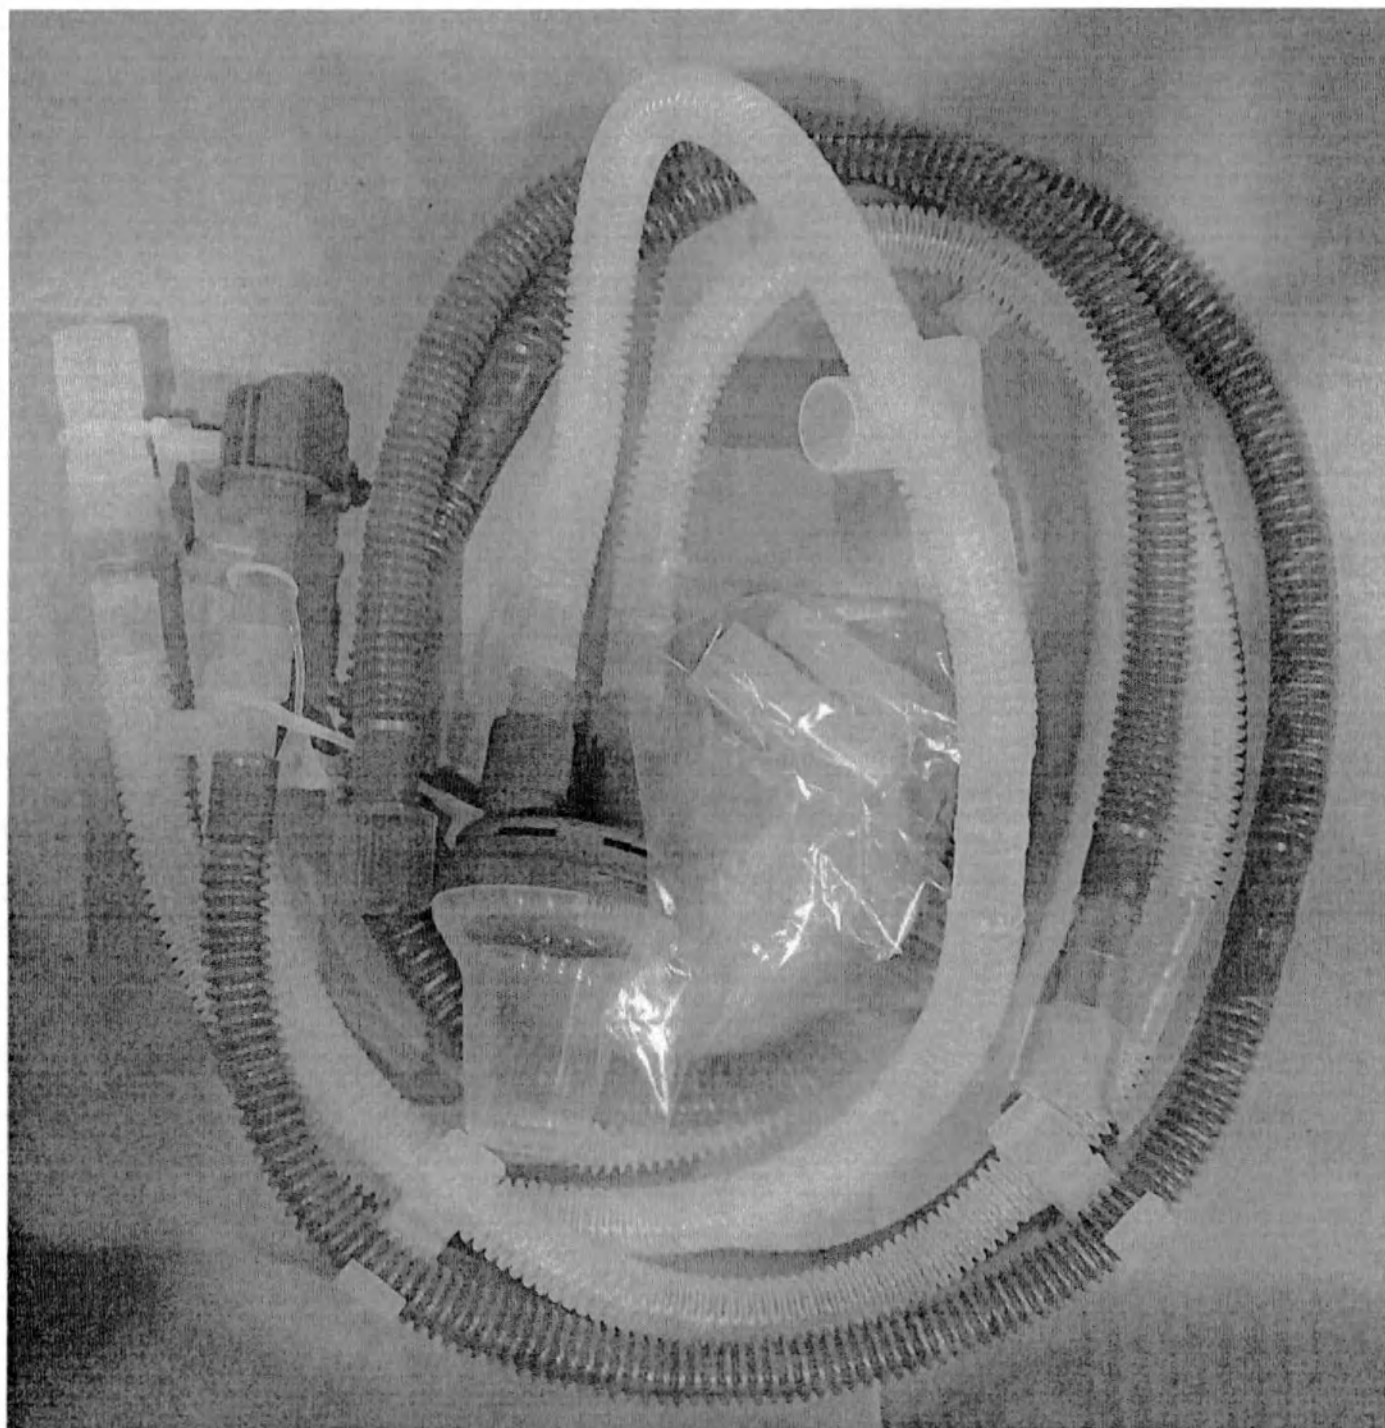


15 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для детей с обогревом, 4504850, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

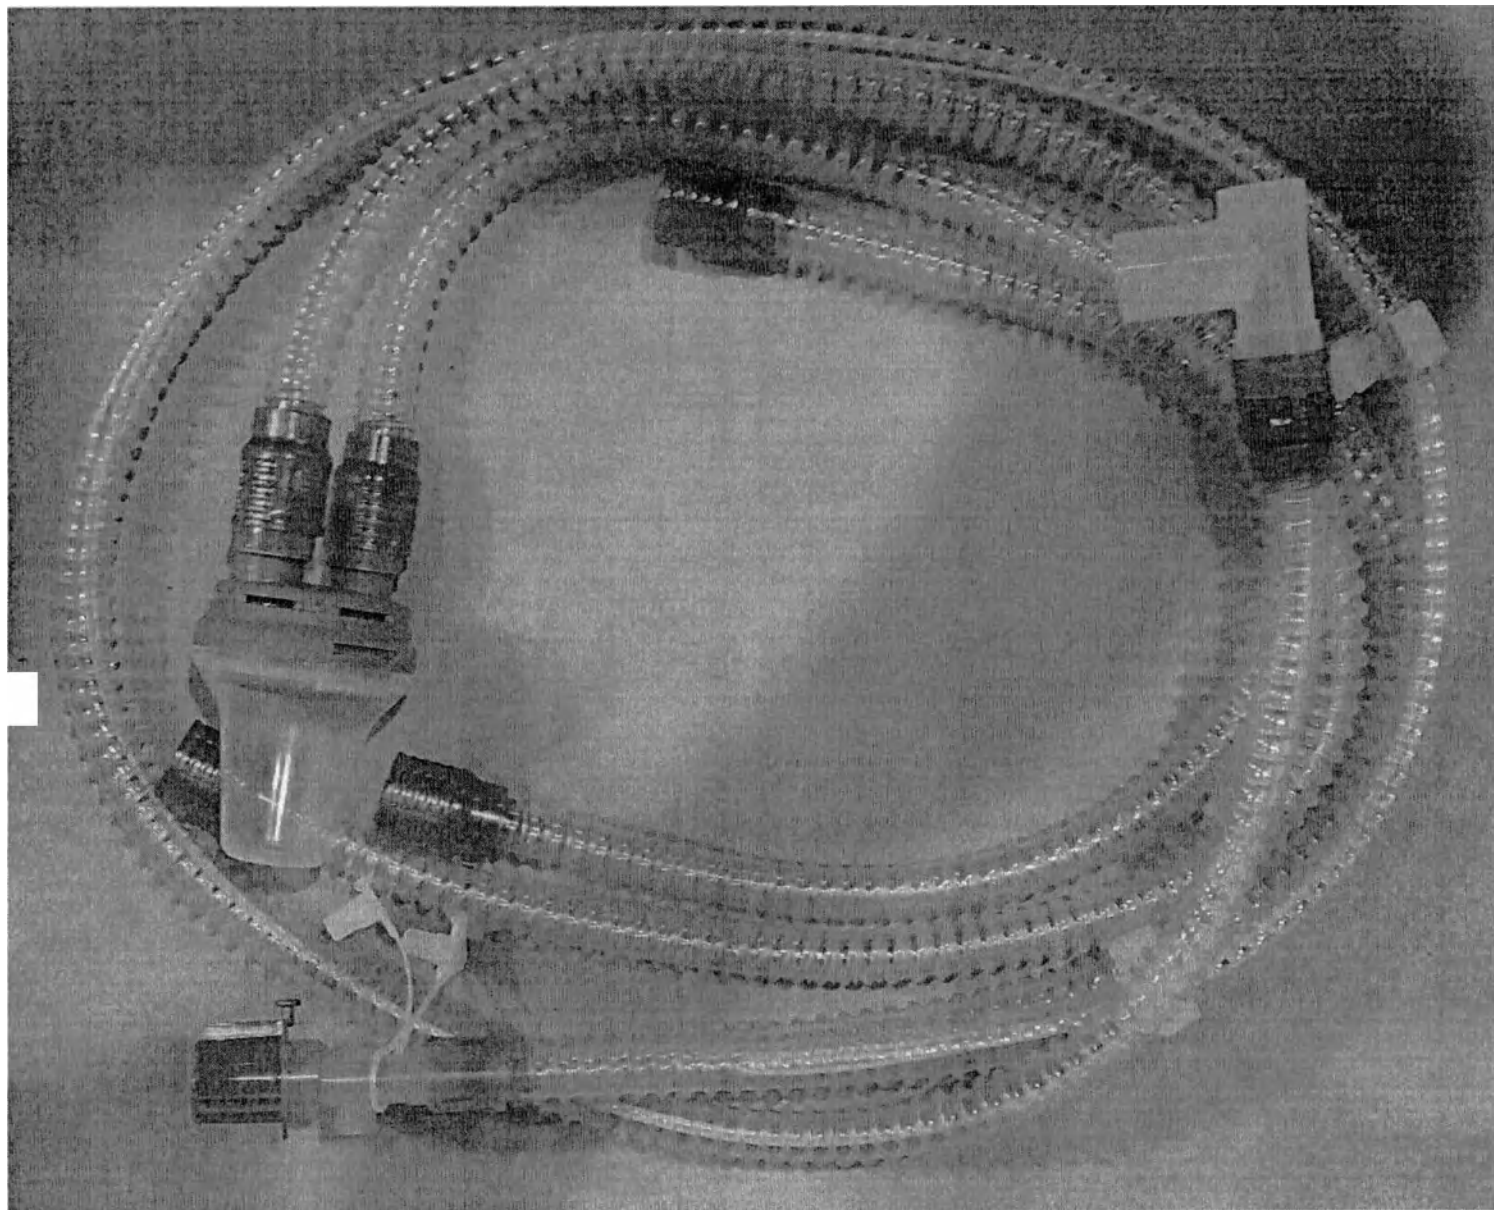


Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для детей с обогревом, 5504850, с принадлежностями: планги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

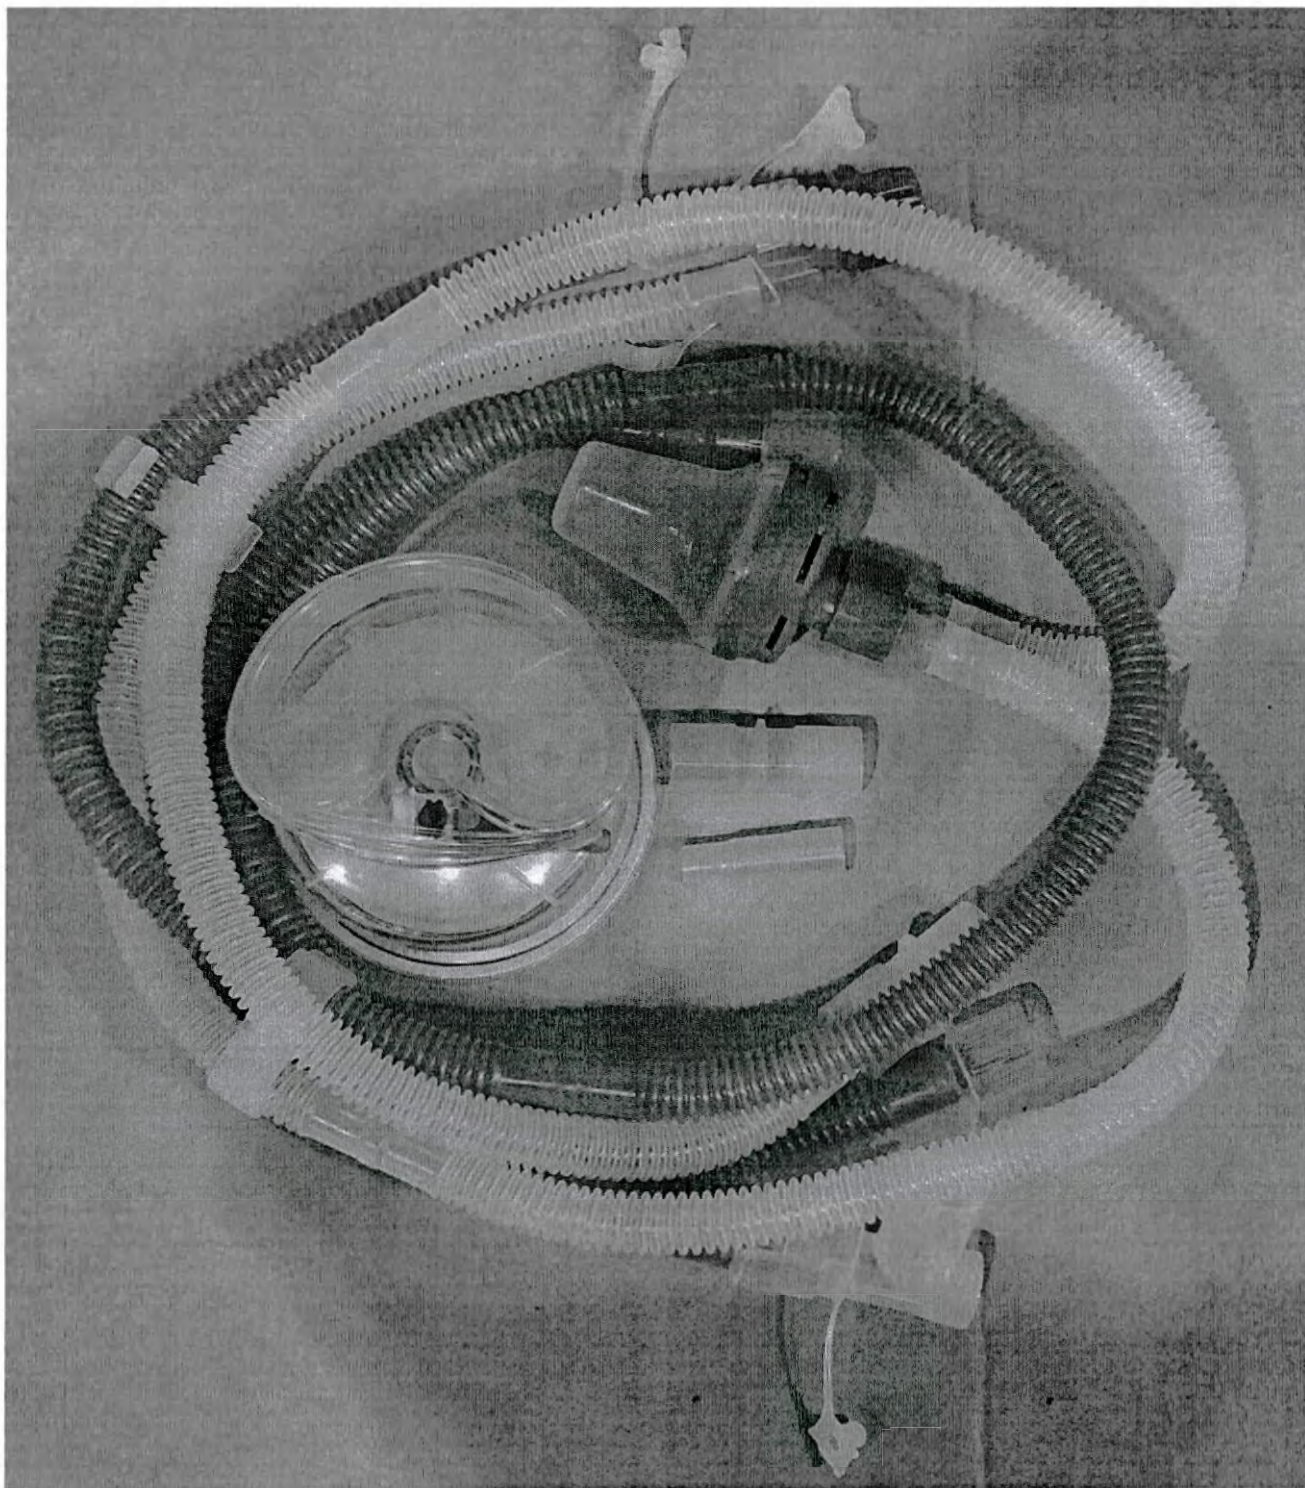


15 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для детей с обогревом, 4504810, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), камера увлажнителя, влагосборник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

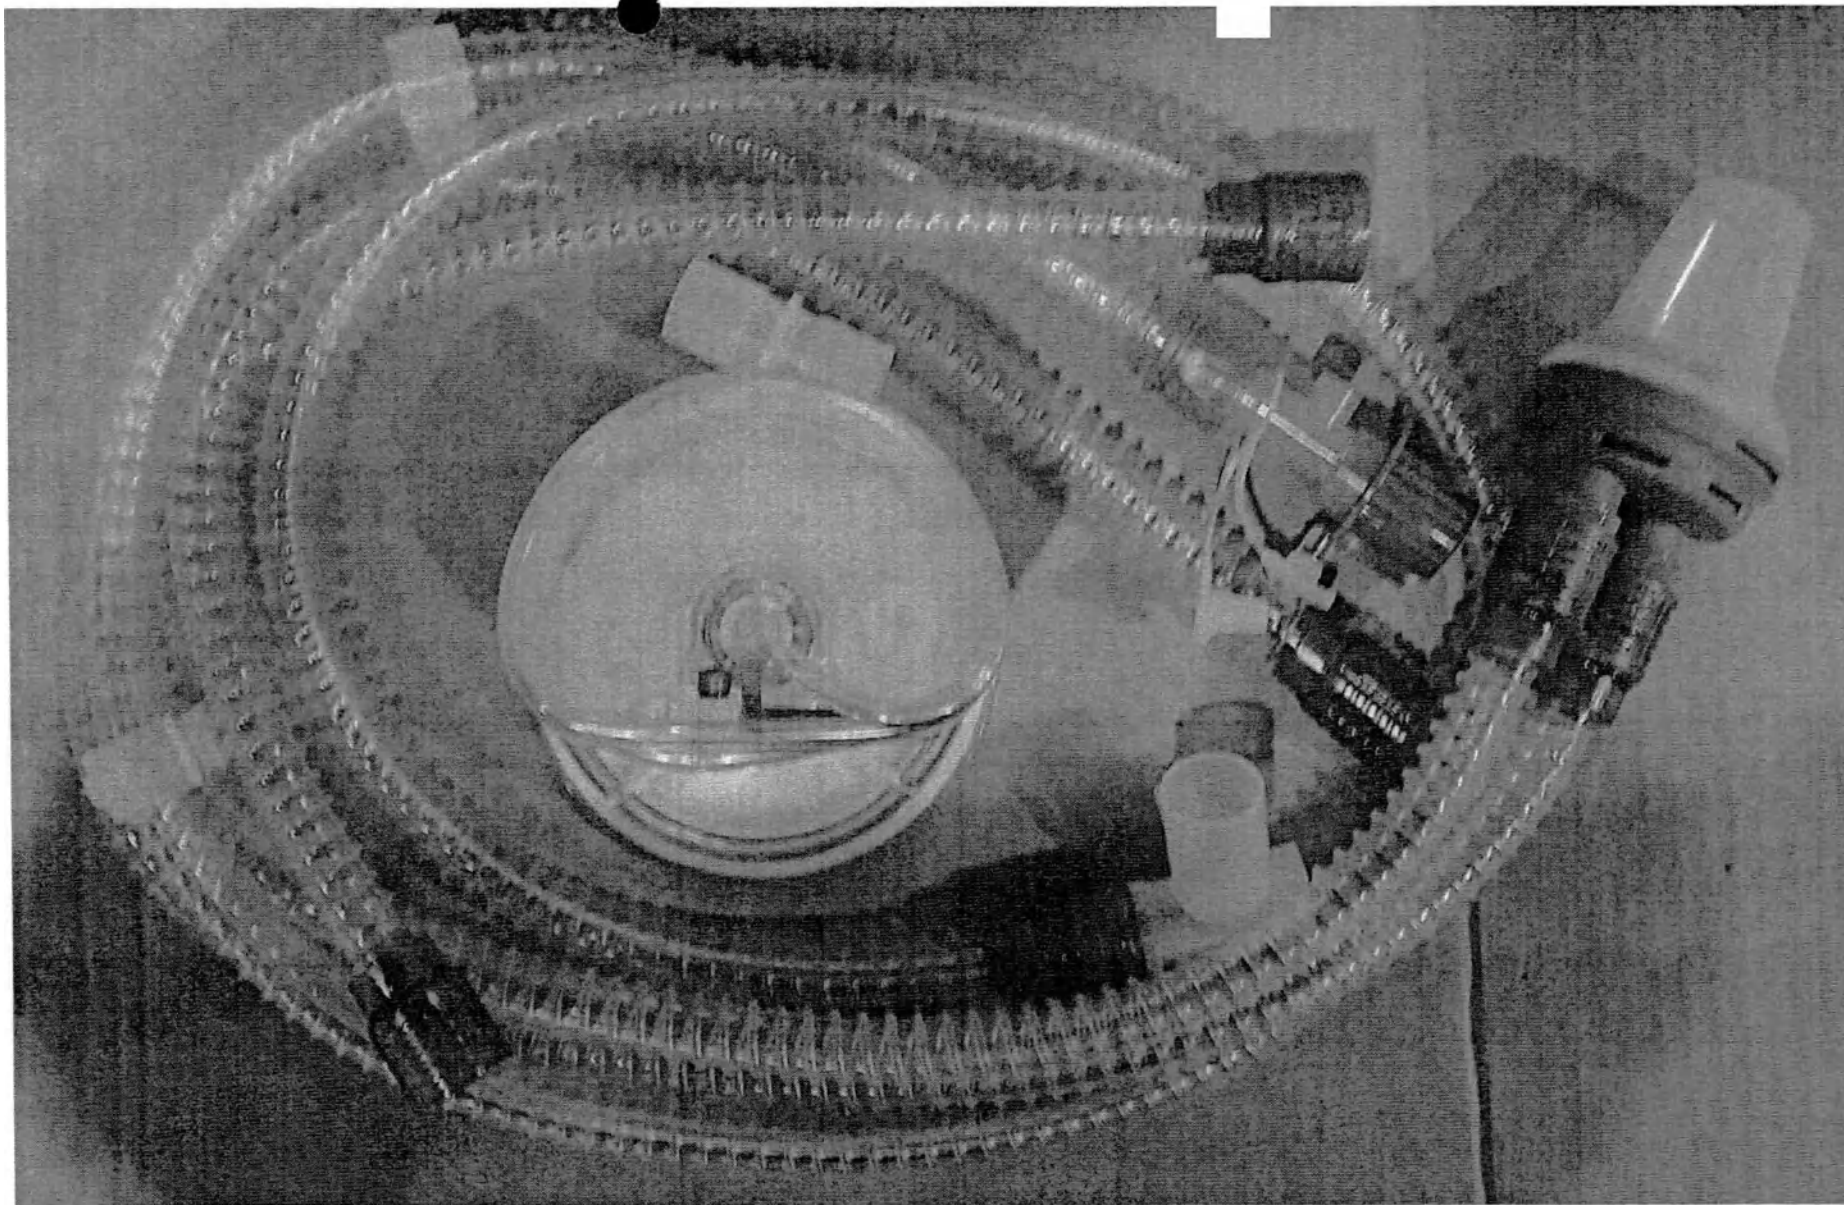


15 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для детей с обогревом, 5504810, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), камера увлажнителя, влагосорбник (1 шт.), держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

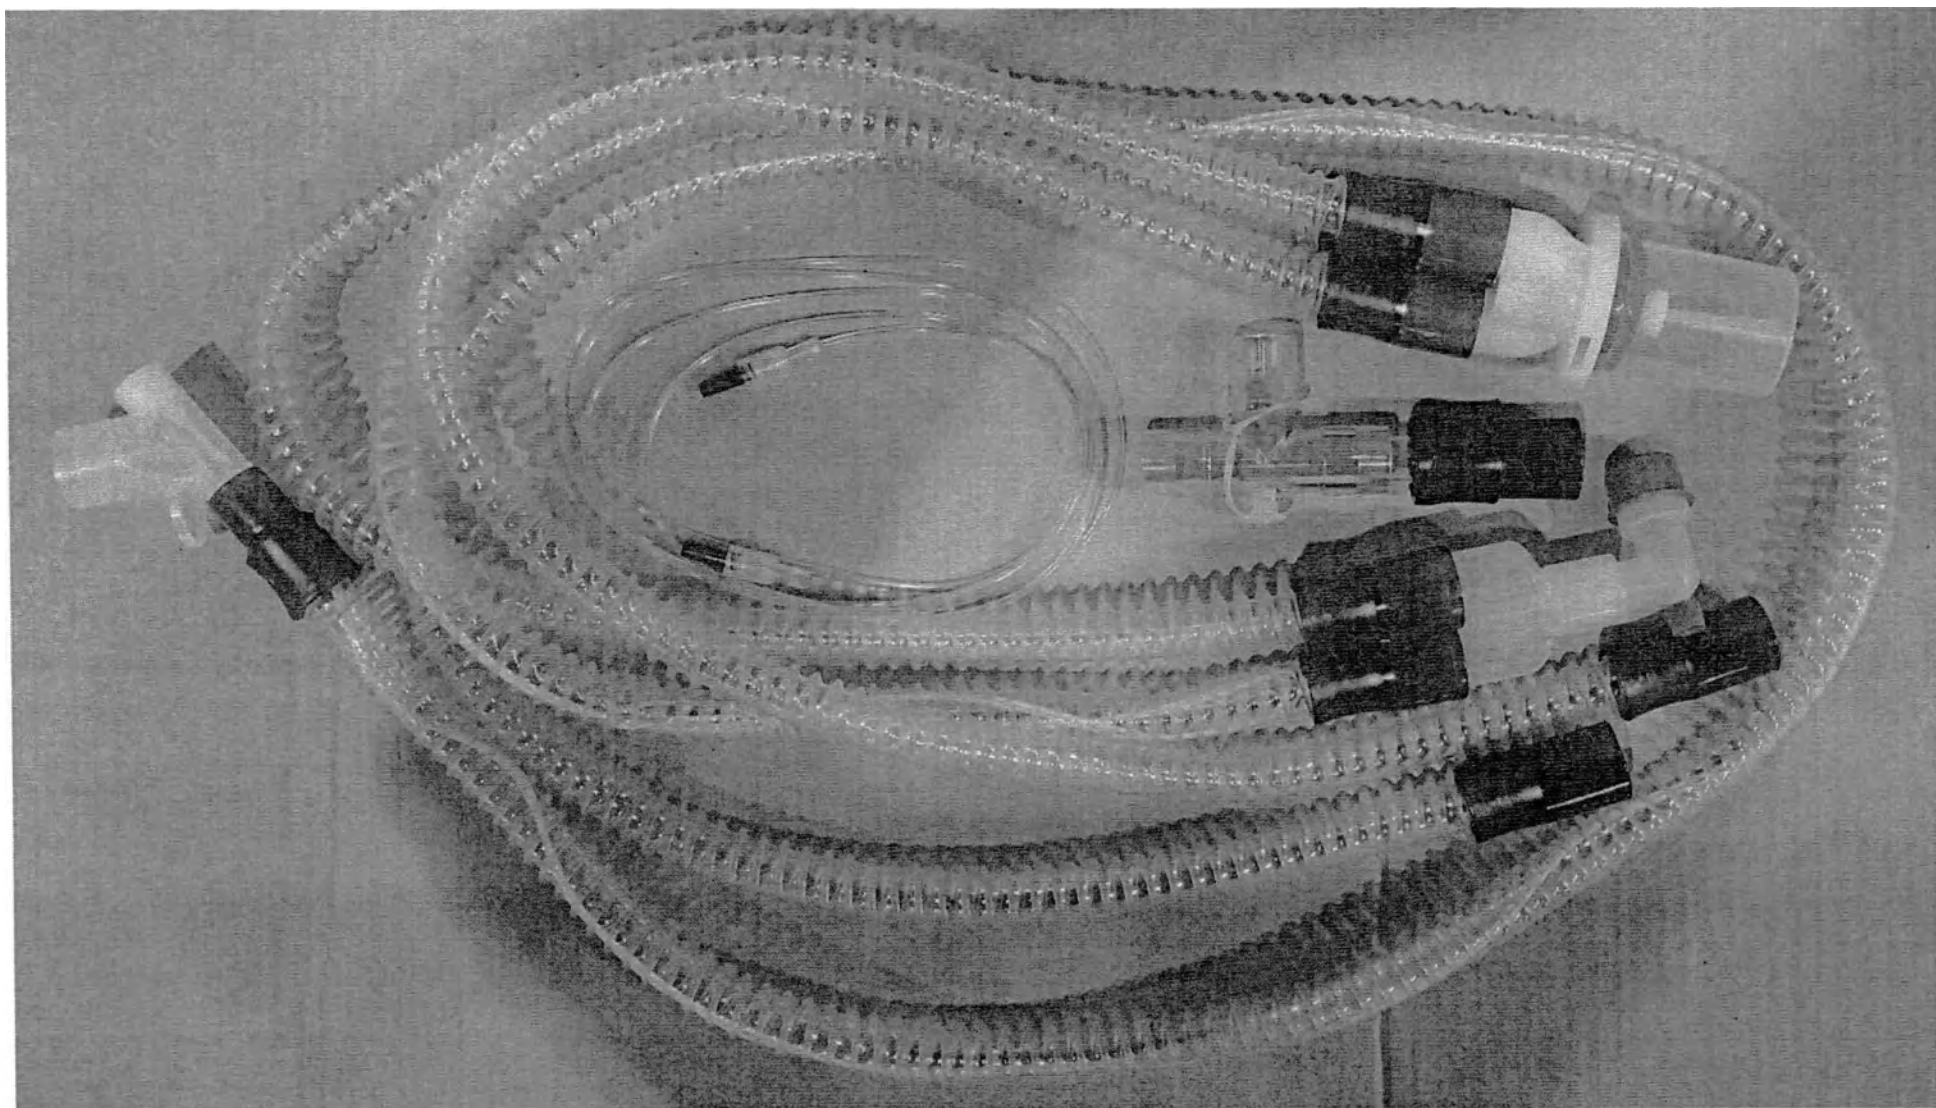


15 Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный для аппарата ИВЛ стандартный, 5602Г, в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 4шт., угловой адаптер – 1шт., Т-коннектор – 1шт., влагосборник – 1шт., трубка (0,8м) – 3шт., трубка (1,6м) – 1шт., трубка (2,0м) – 1шт., РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО “Ассомедика”, Беларусь

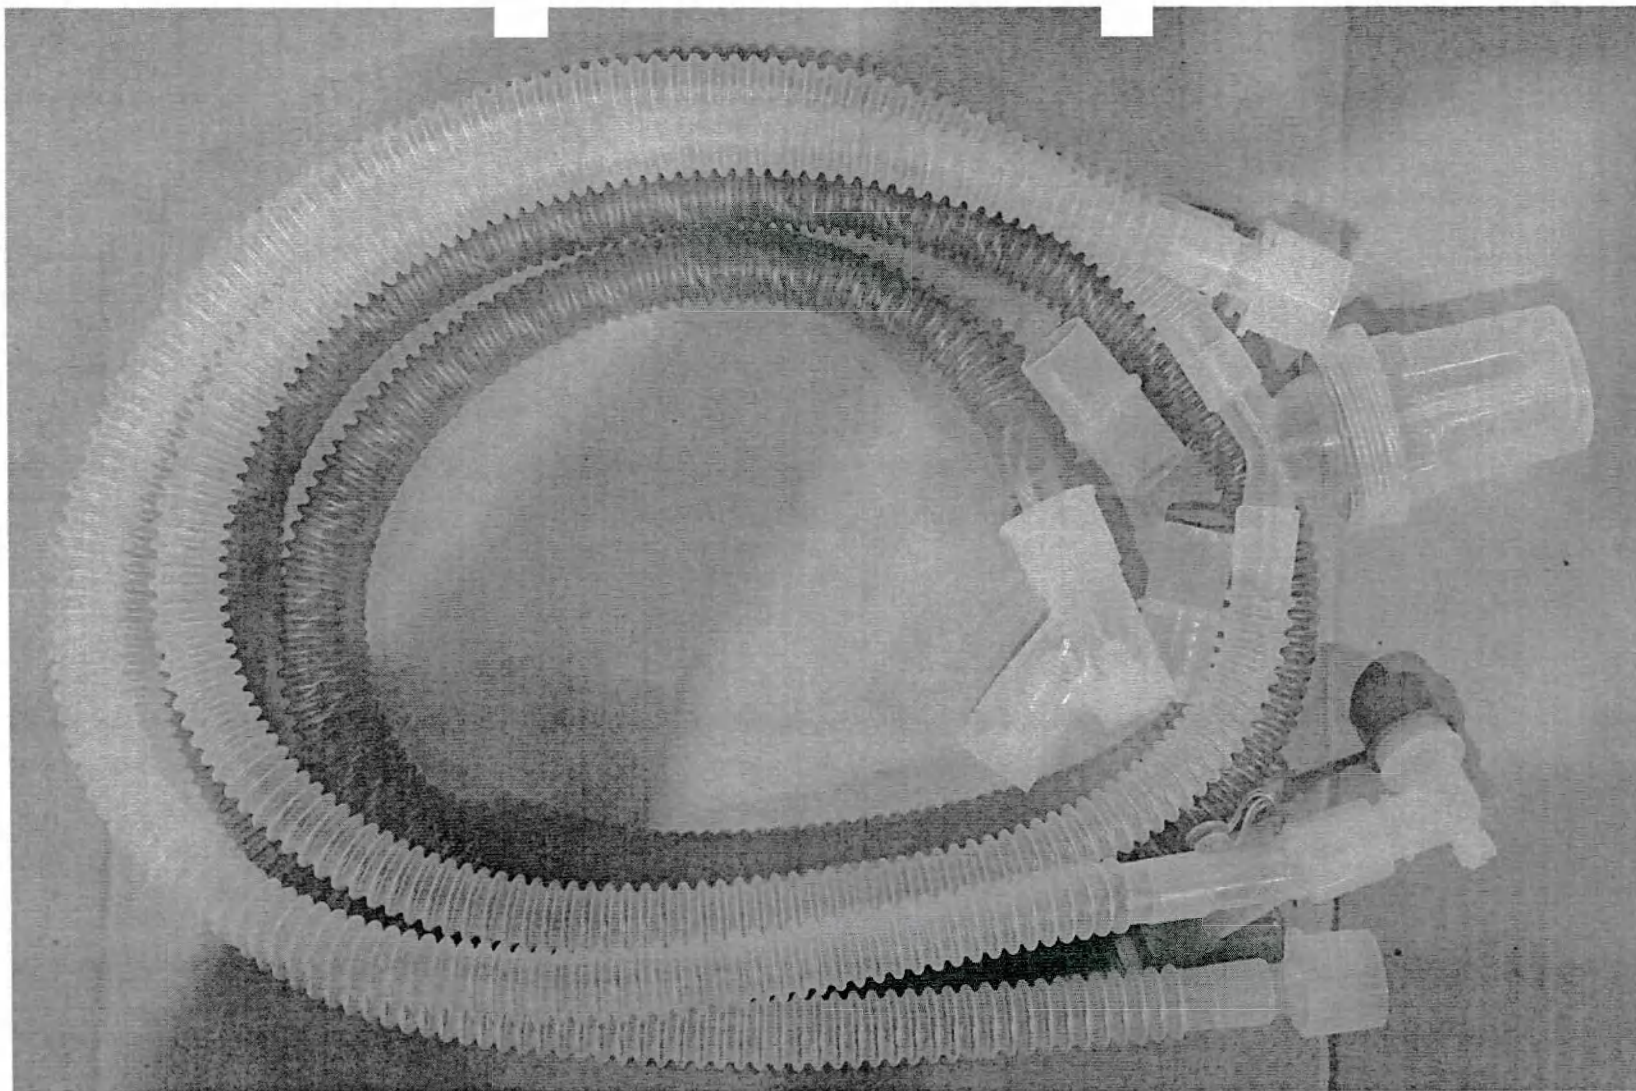


15 Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019, в вариантах исполнения: устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом, 103700001, в составе: трубка гофрированная – 3 шт., трубка гофрированная обогреваемая – 1 шт., коннектор прямой - 10 шт., Y-образный коннектор - 1 шт., влагосборник – 1 шт., линия контроля давления – 1 шт., камера для увлажнителей дыхательных смесей – 1шт., РУ № РЗН 2020/10066, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия

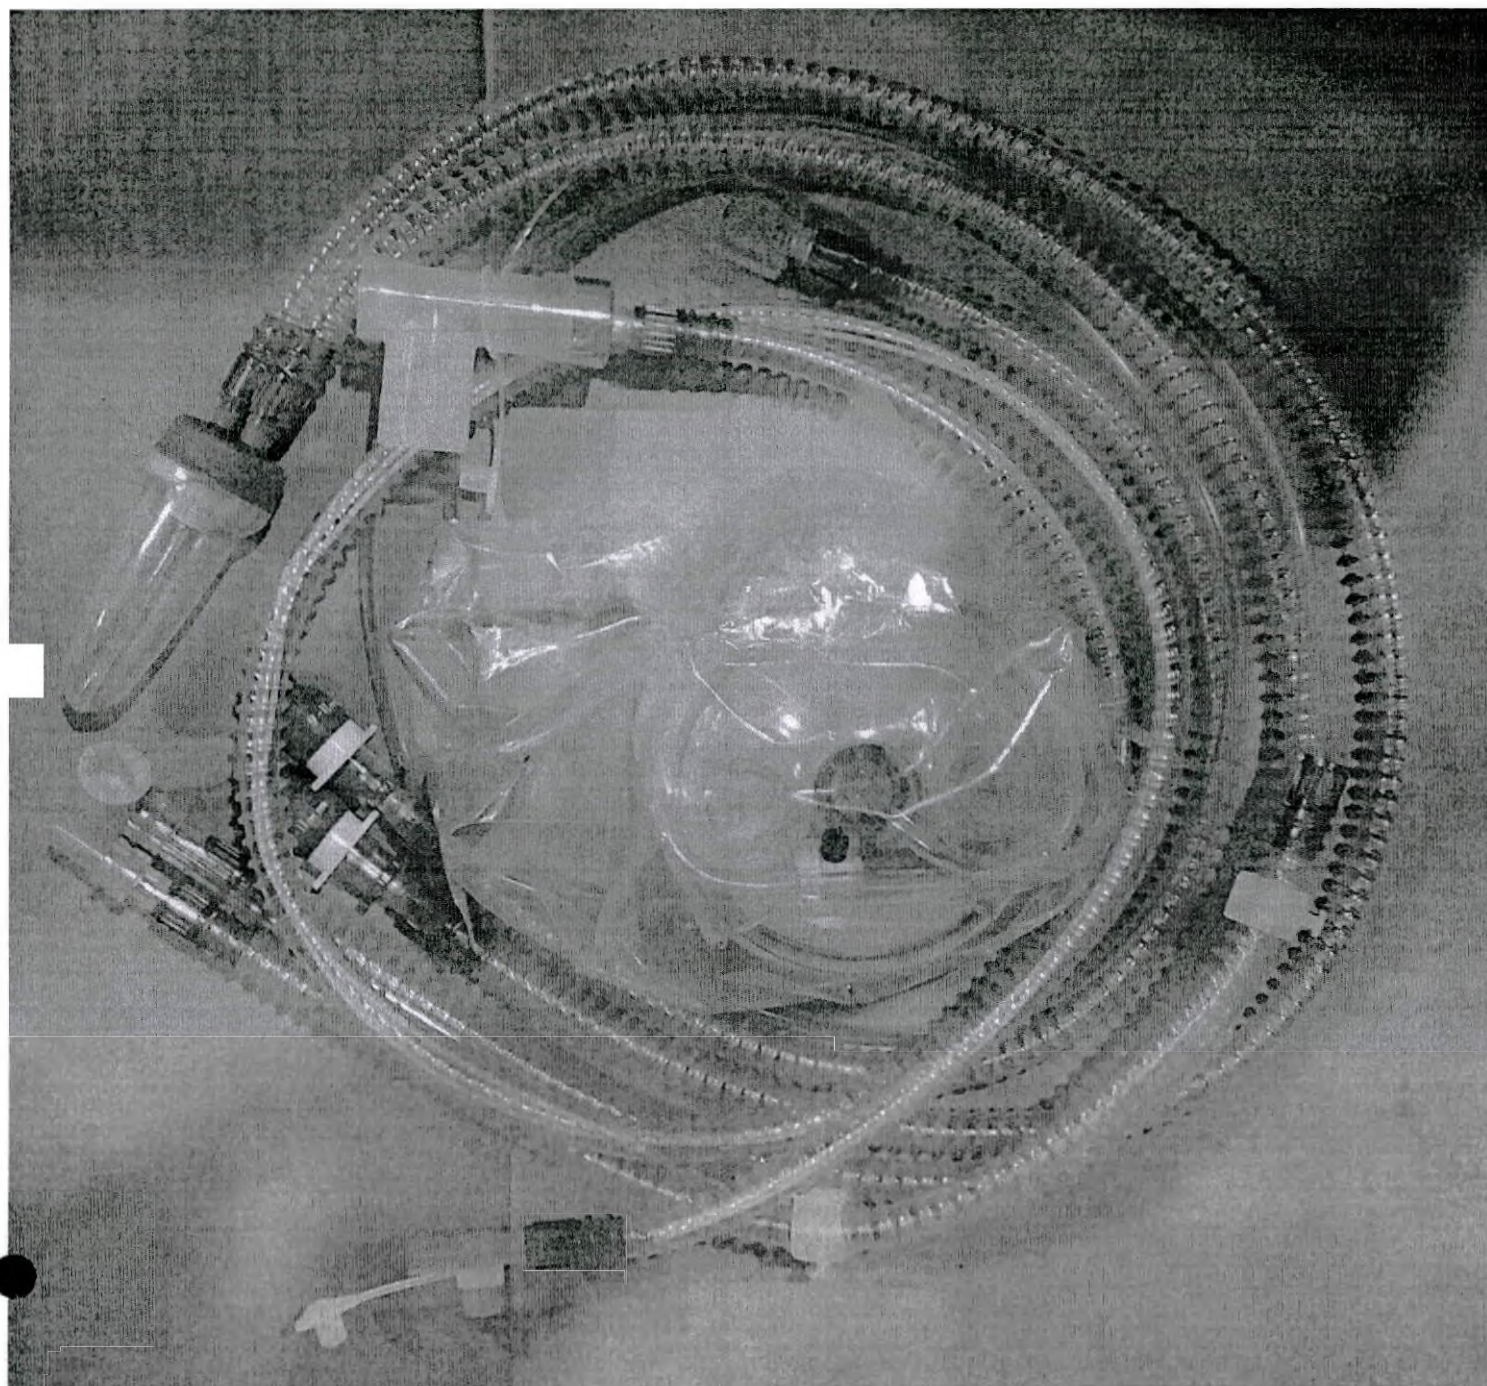


16 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом, 5510810, с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5 шт.), соединители (до 7 шт.), влагосборник (1 шт.), камера увлажнителя, линия мониторинга, держатели-фиксаторы (до 3 шт.), РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

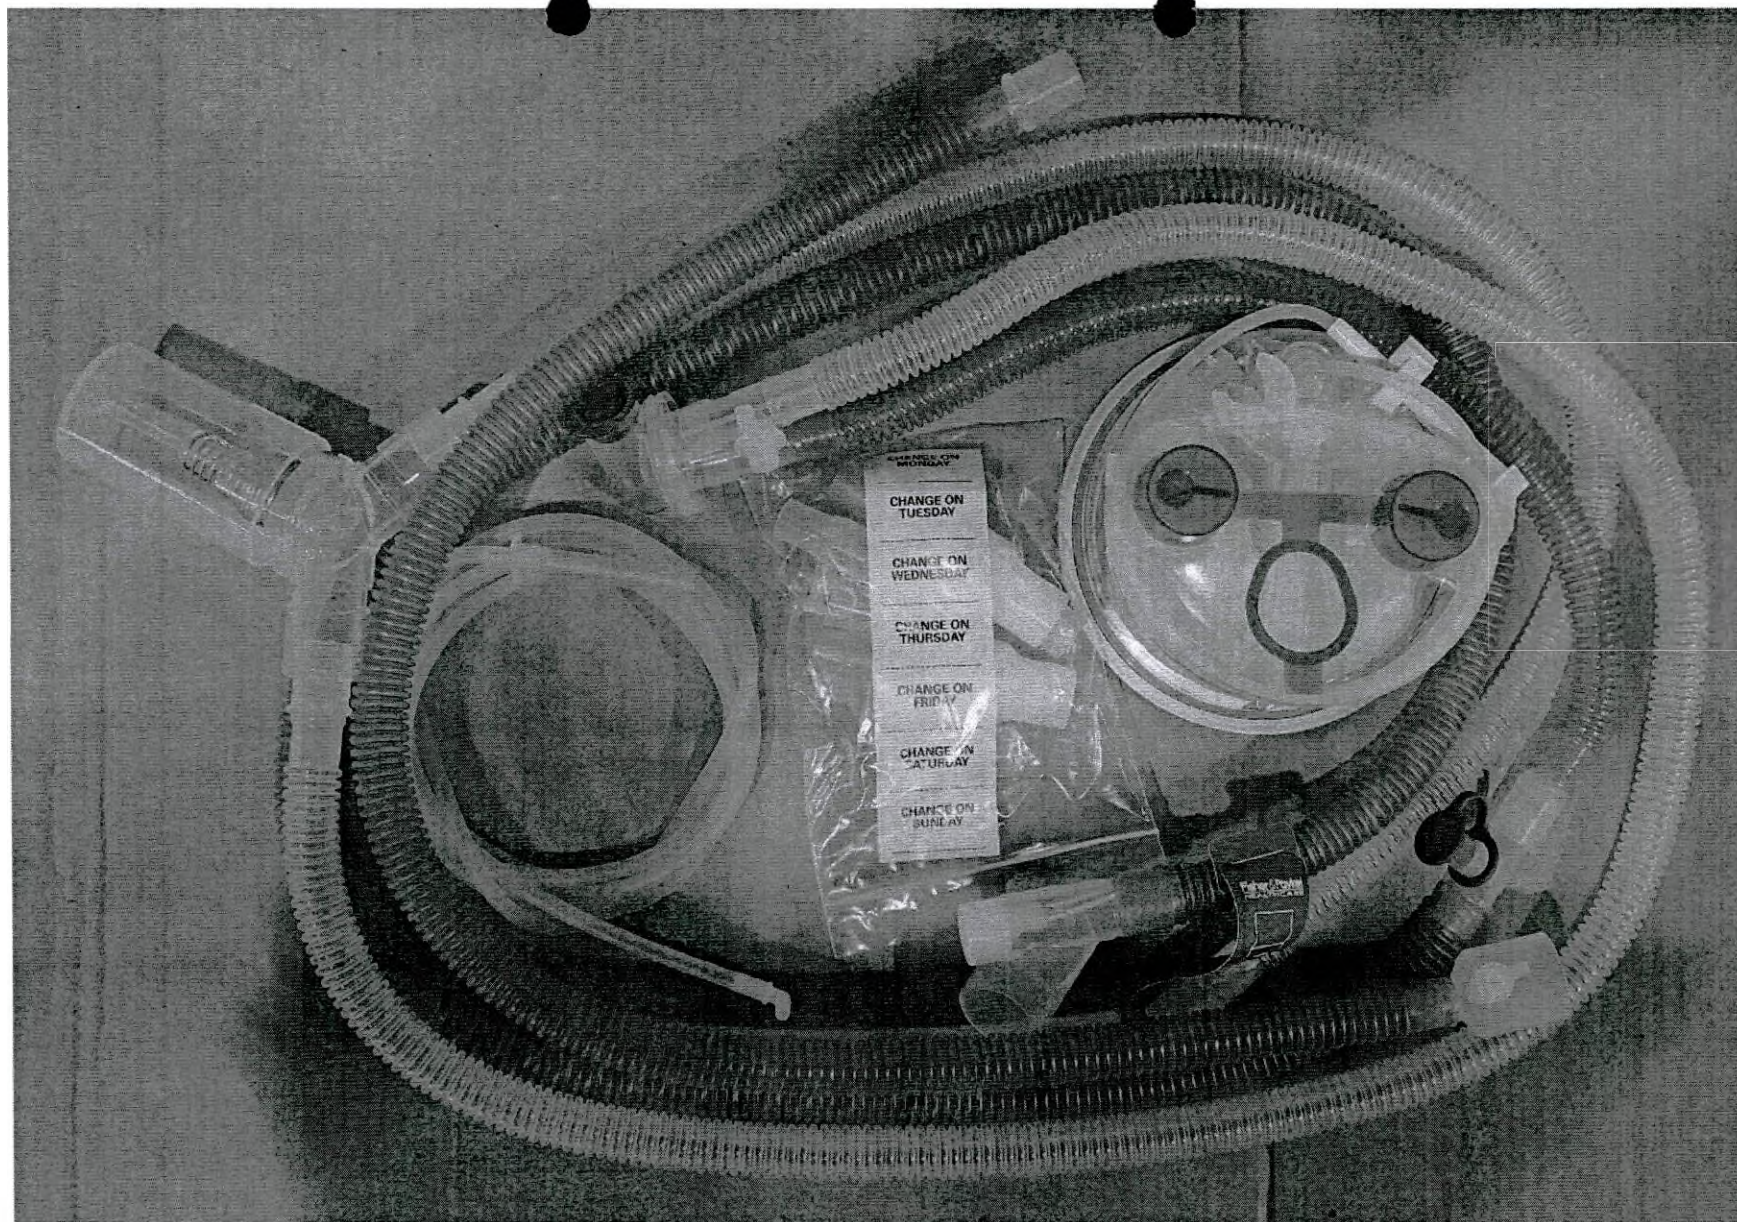


16 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: - RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

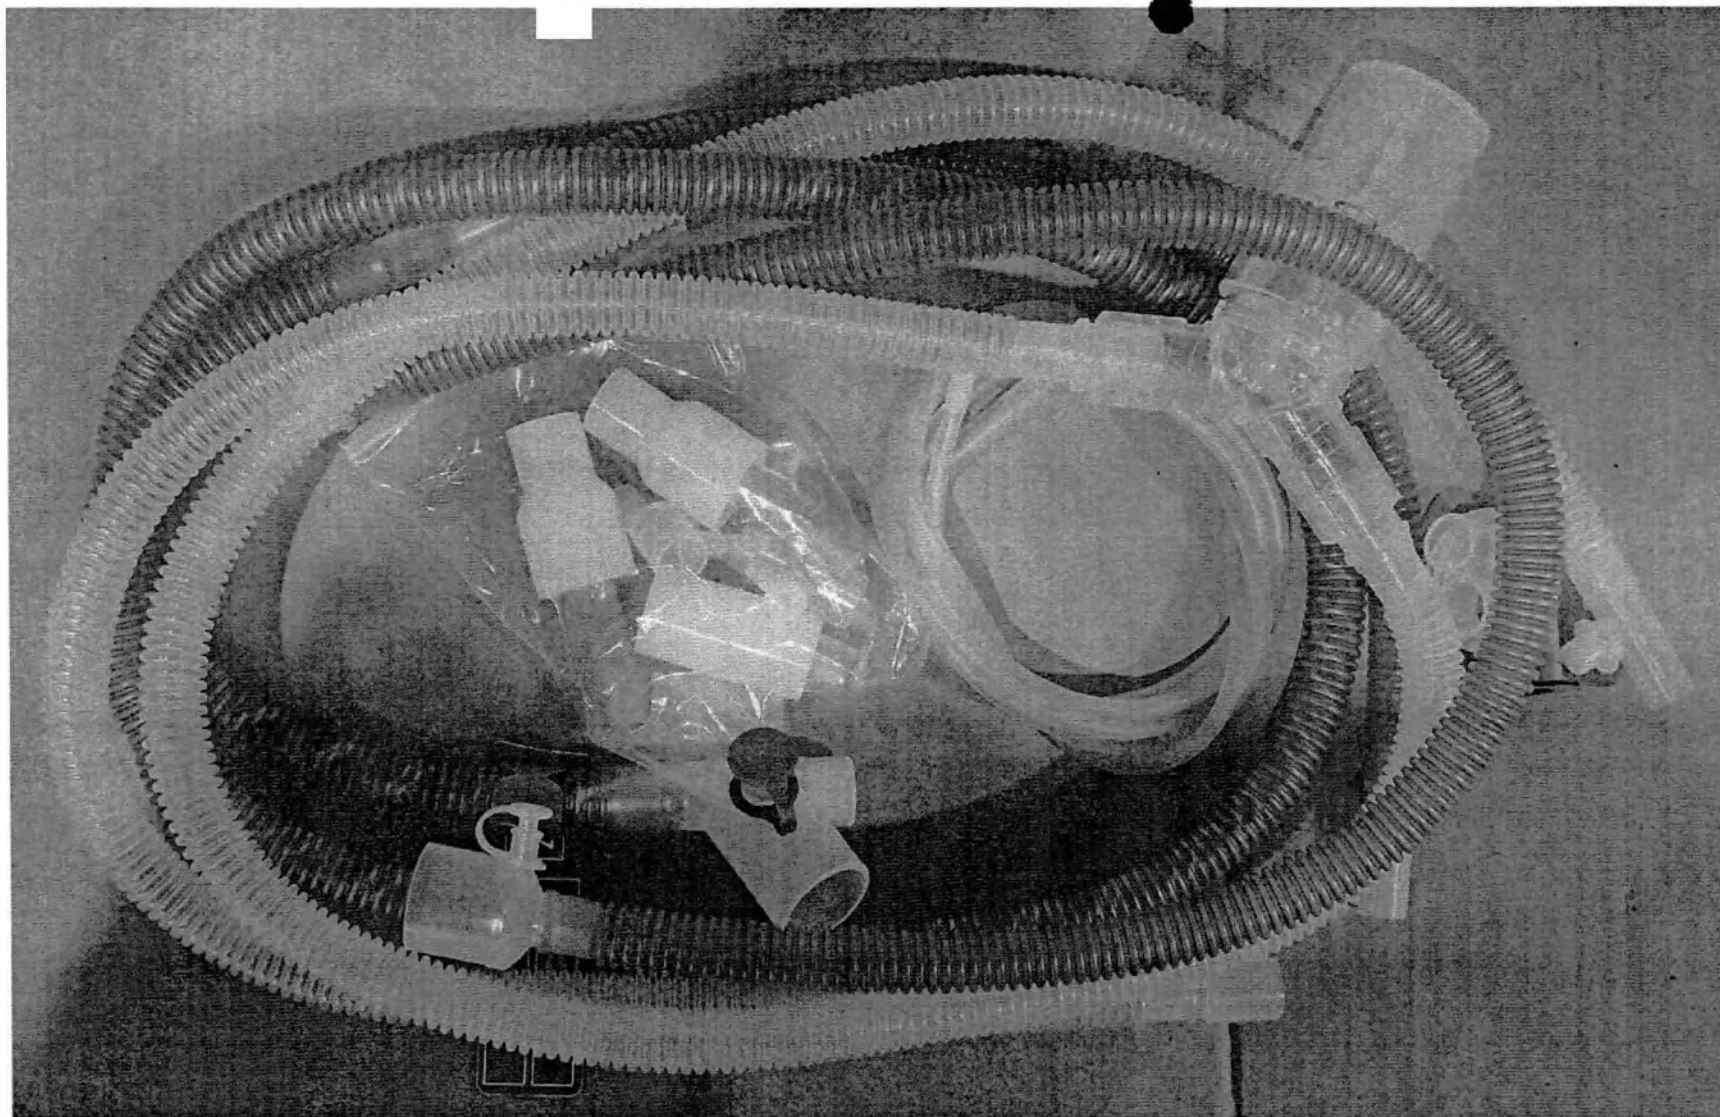


16 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: - RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

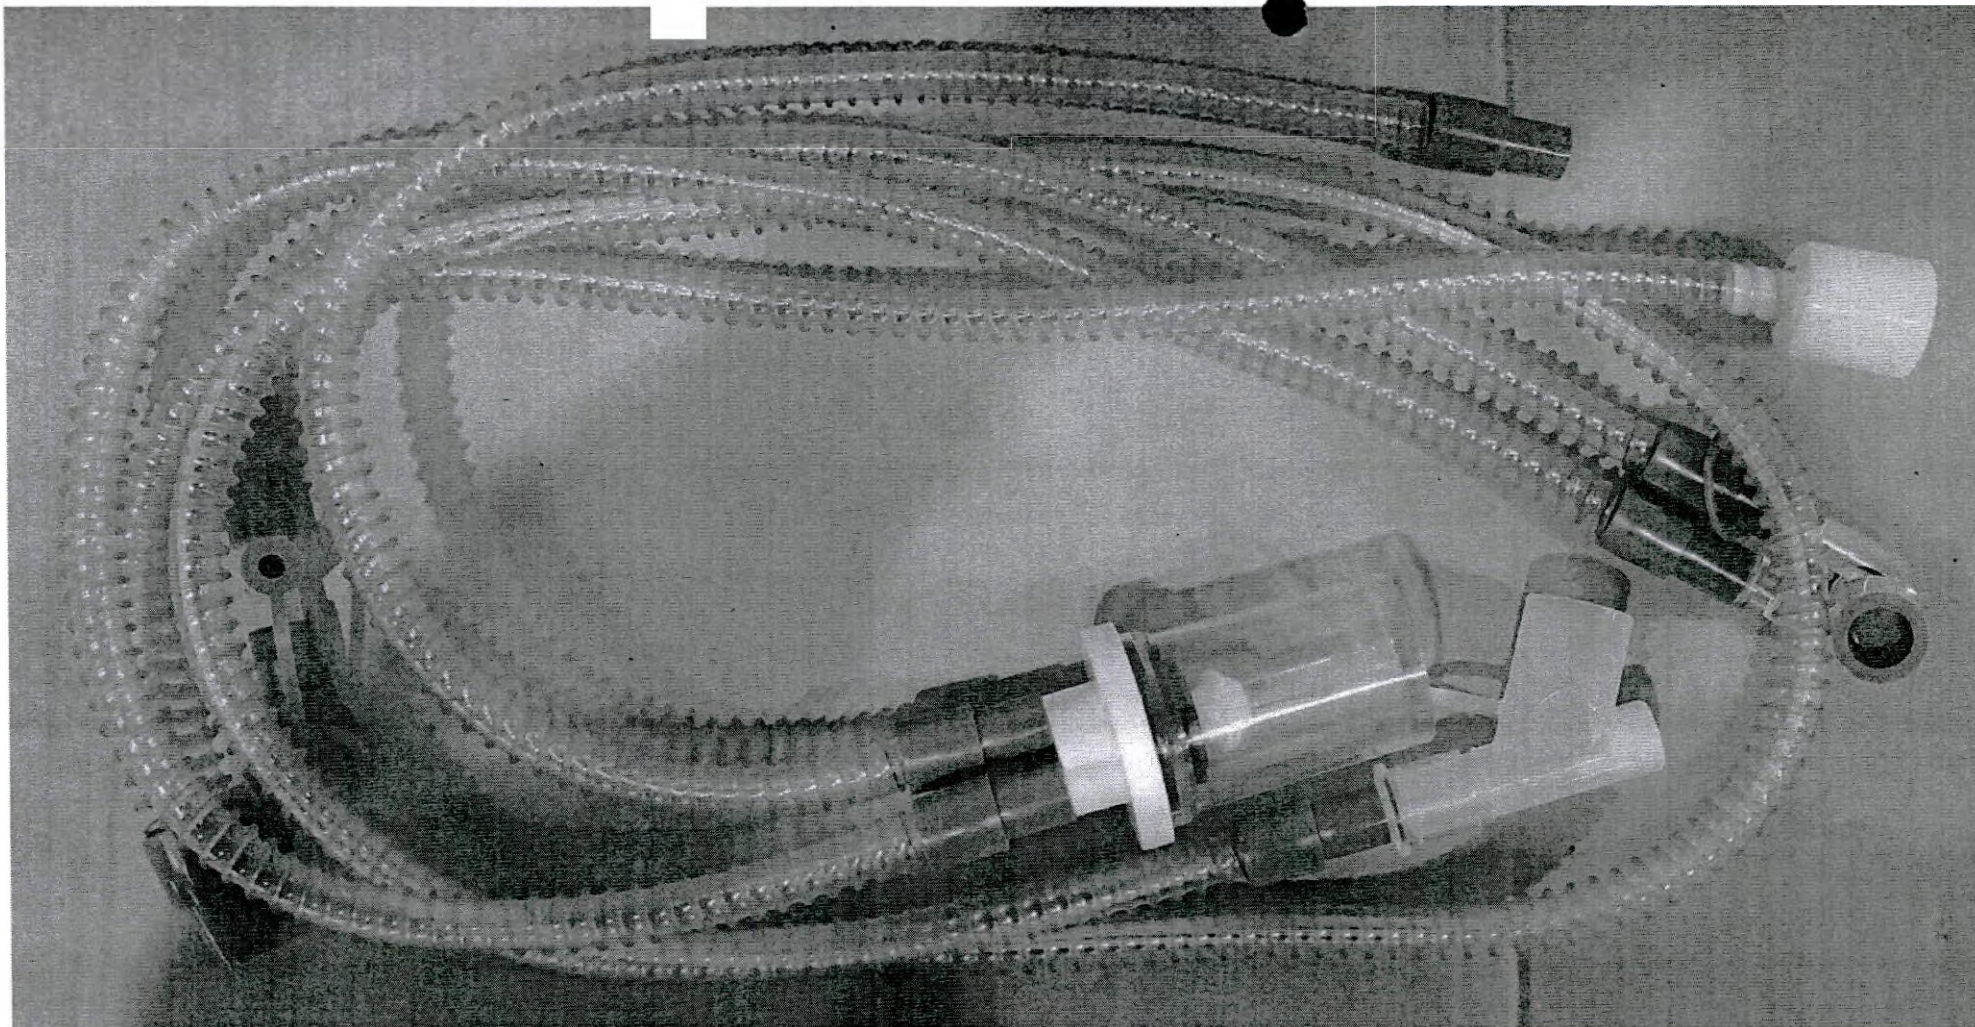

16 Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный специальный, 6604Н, в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 8шт., Т-коннектор – 1шт., влагосборник – 1шт., трубка (0,4м) – 1шт., трубка (0,5м), РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО «Ассомедика», Беларусь

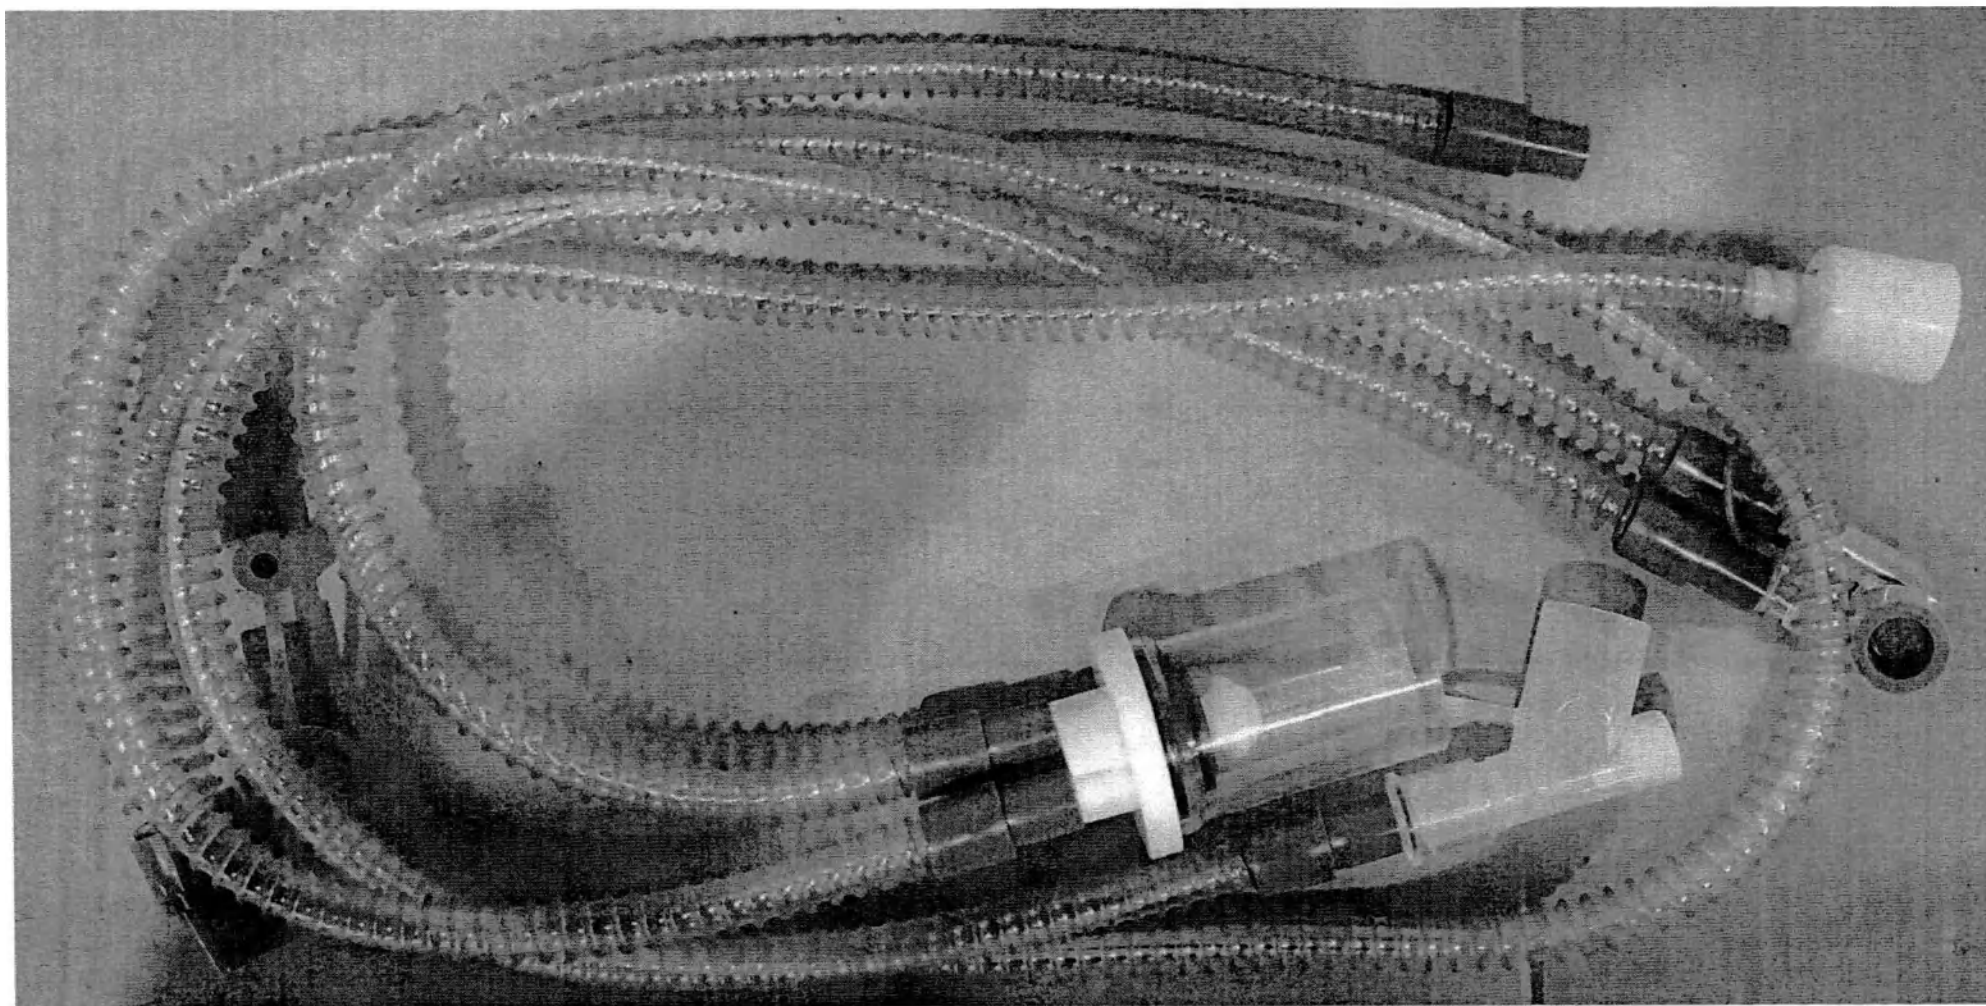


16 Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный специальный, 6604Г, в составе: У-адаптор - 1шт., прямой адаптер - 8шт., Т-коннектор – 1шт., влагосборник – 1шт., трубка (0,4м) – 1шт., трубка (0,5м), РУ № ФСЗ 2010/06637, ООО «Ассомедика», Беларусь

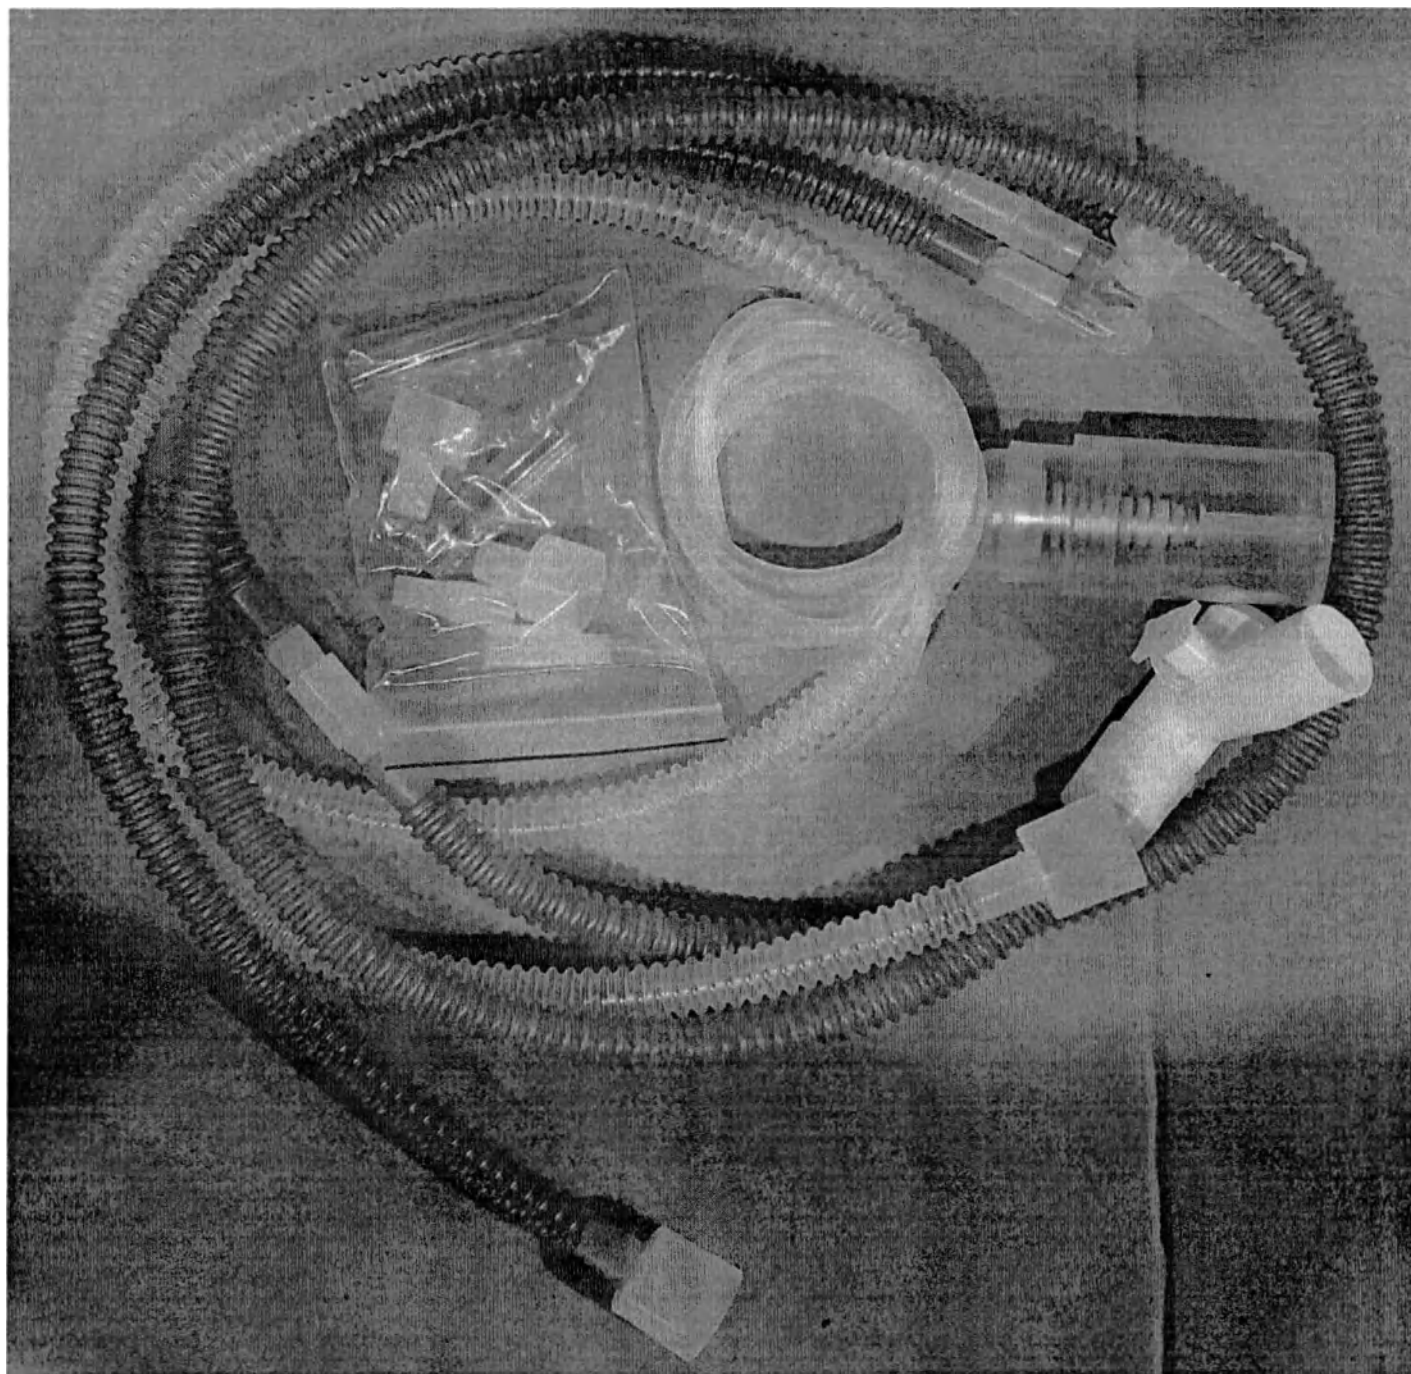


16 Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019, в вариантах исполнения: устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом, 107701464, в составе: трубка гофрированная - 4 шт., трубка гофрированная обогреваемая – 1 шт., коннектор прямой – 11 шт., Y-образный коннектор - 1 шт., влагосборник – 1 шт., линия контроля давления – 1 шт., РУ № РЗН 2020/10066, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия




17 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках, в составе: - RT224 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

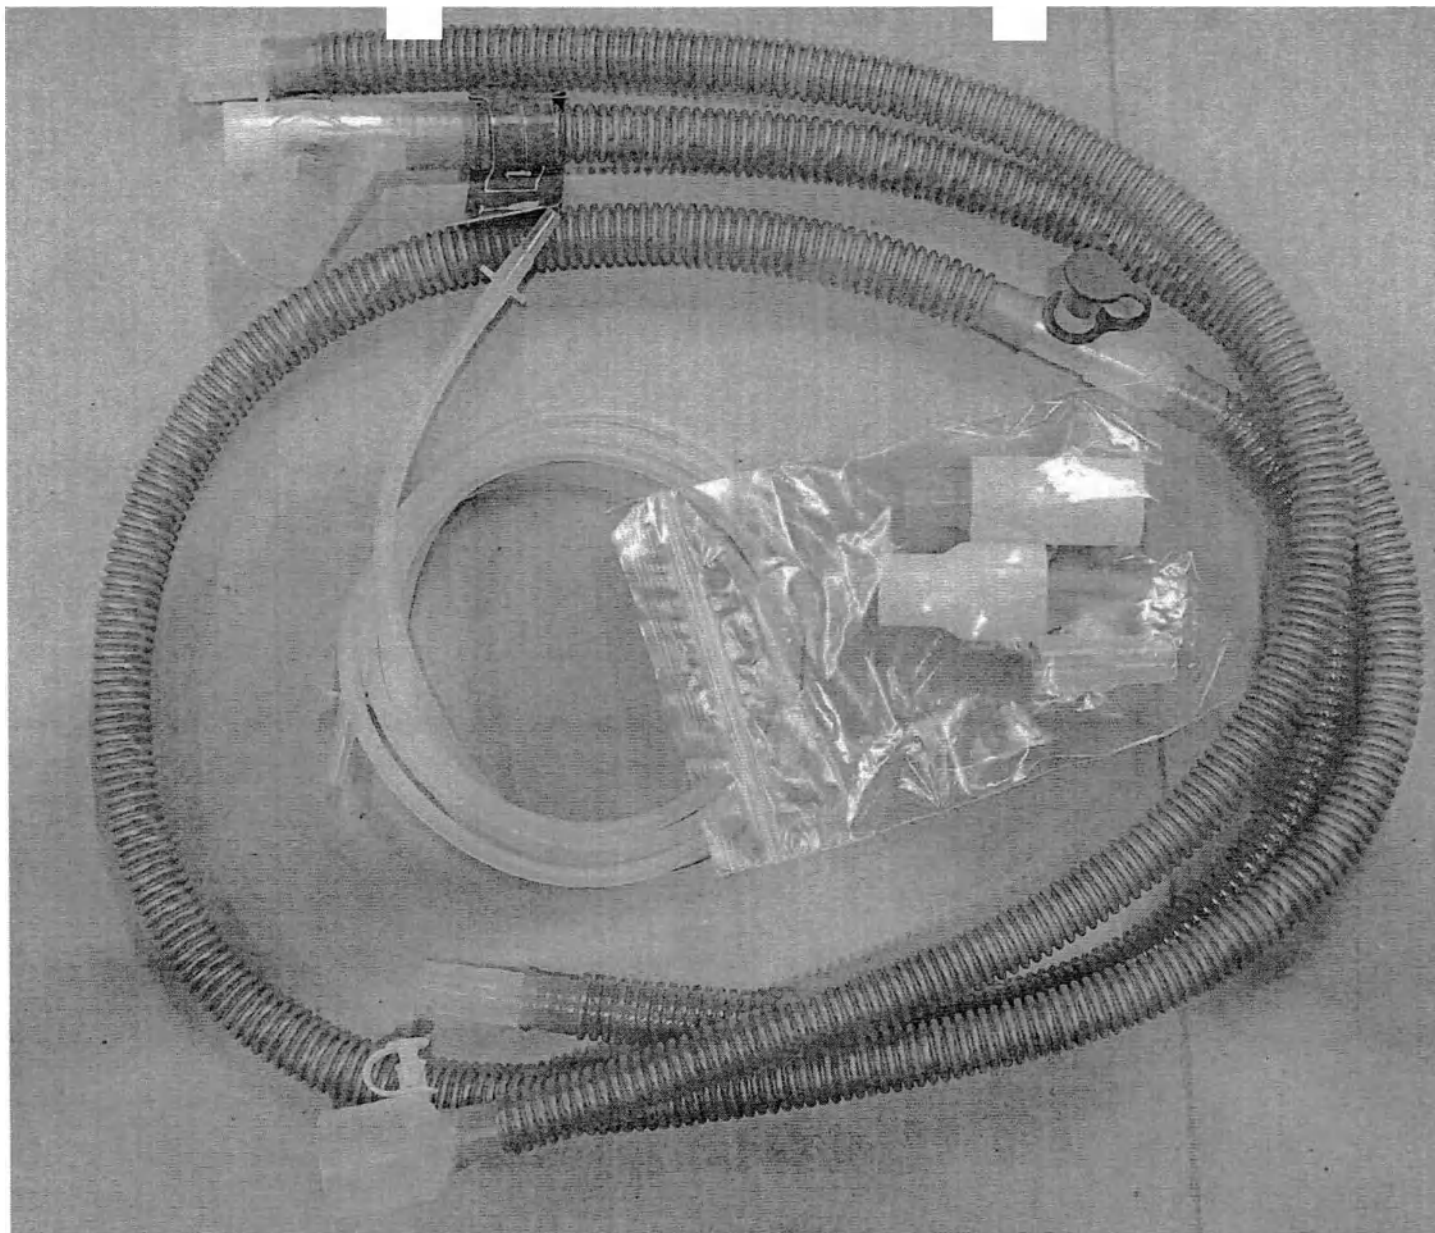


17 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках, в составе: - RT124 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)

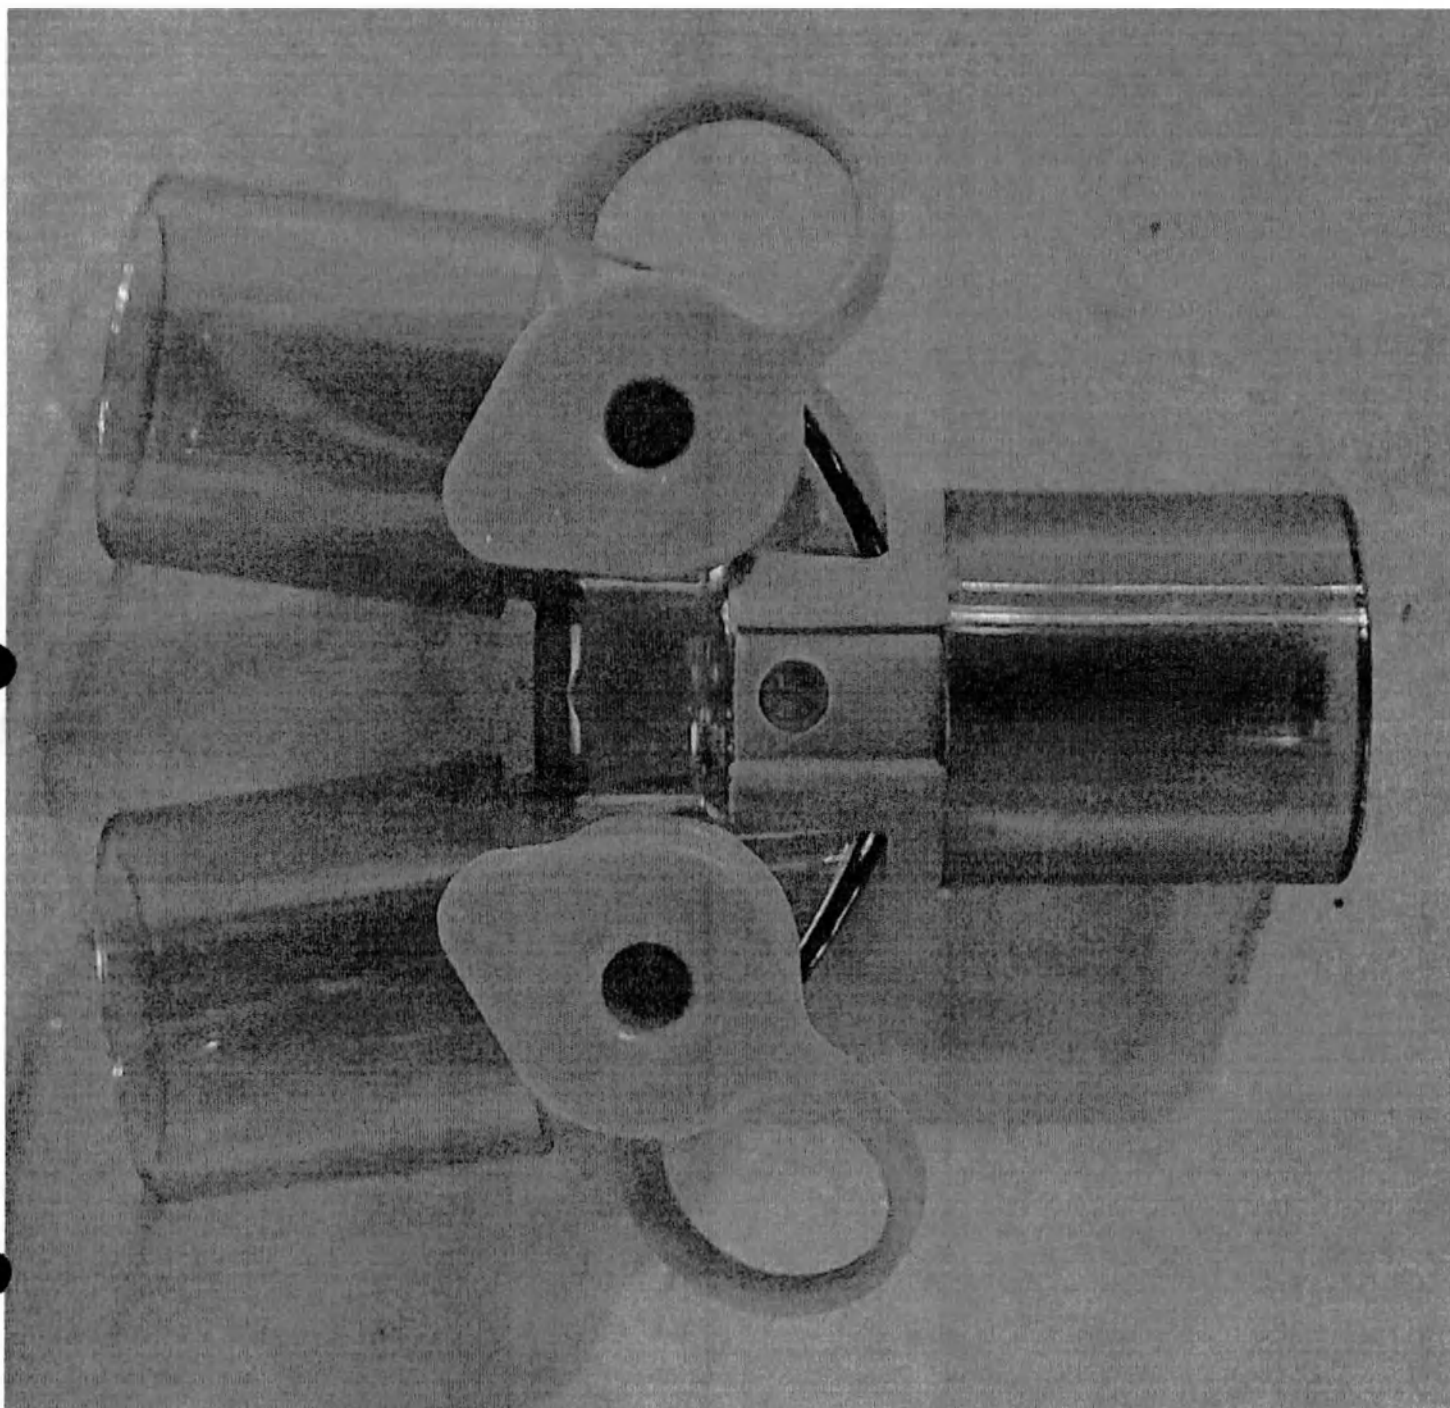

18 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель с портами, без линий мониторинга: жесткий; Y-образный, 9116000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

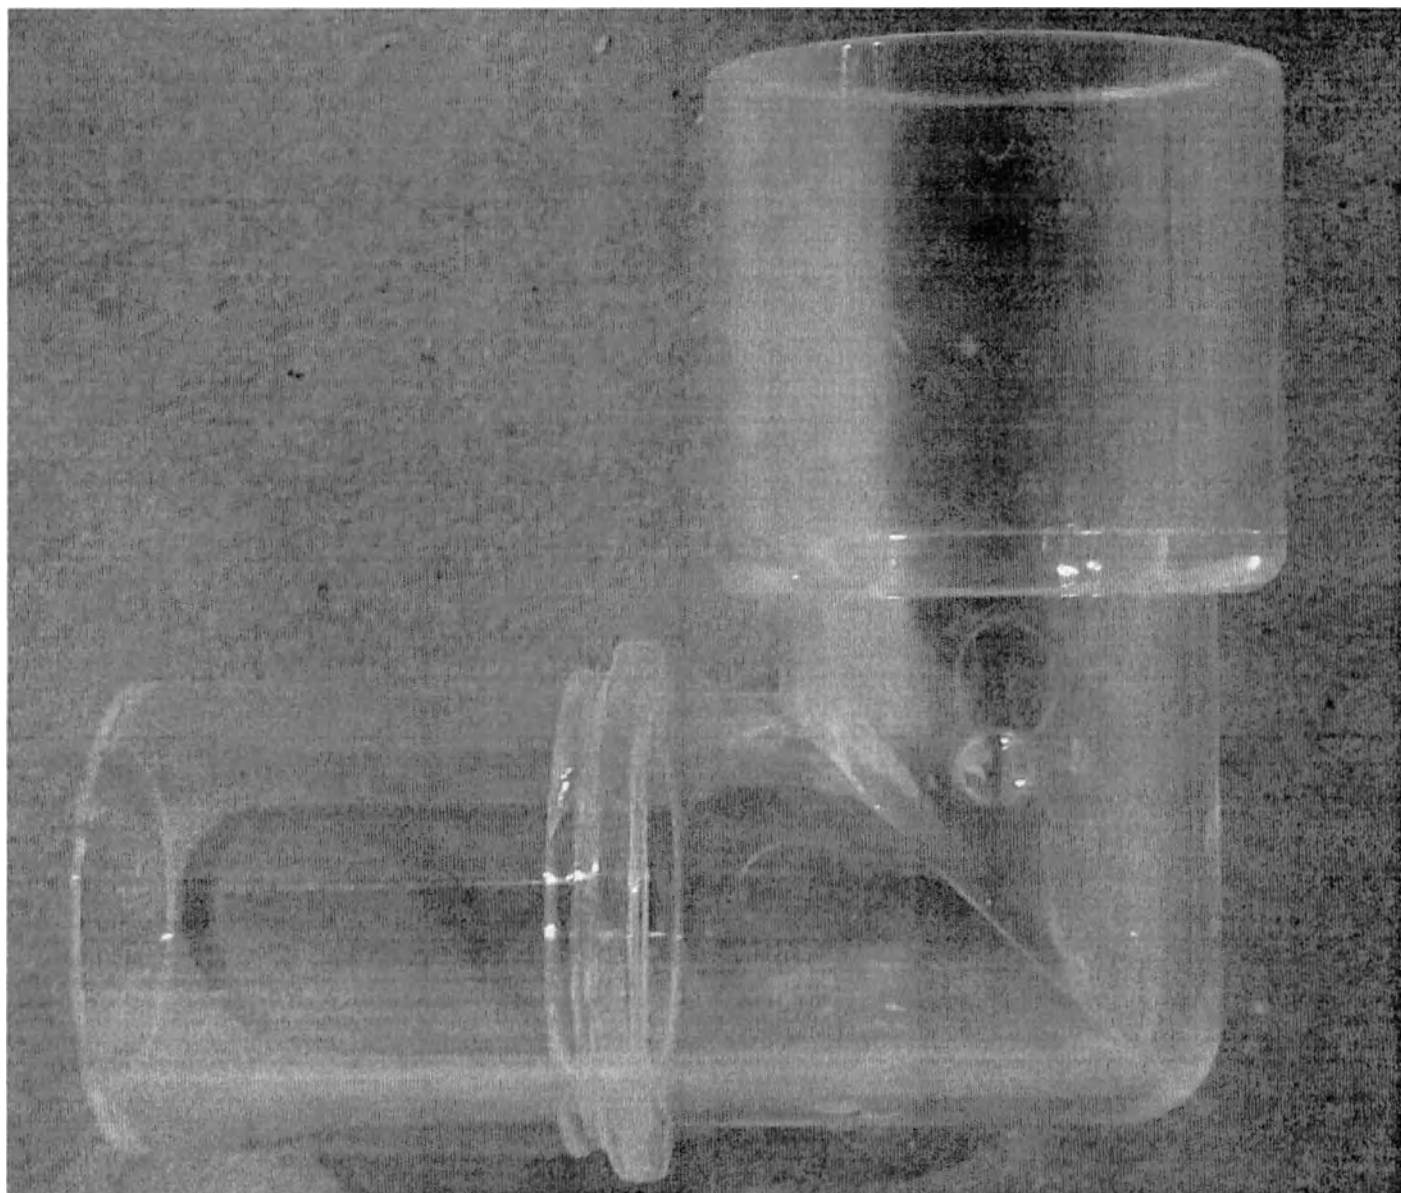


19 Коннектор (угольник), G-311025, «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (VADI Medical Technology Co., Ltd.)

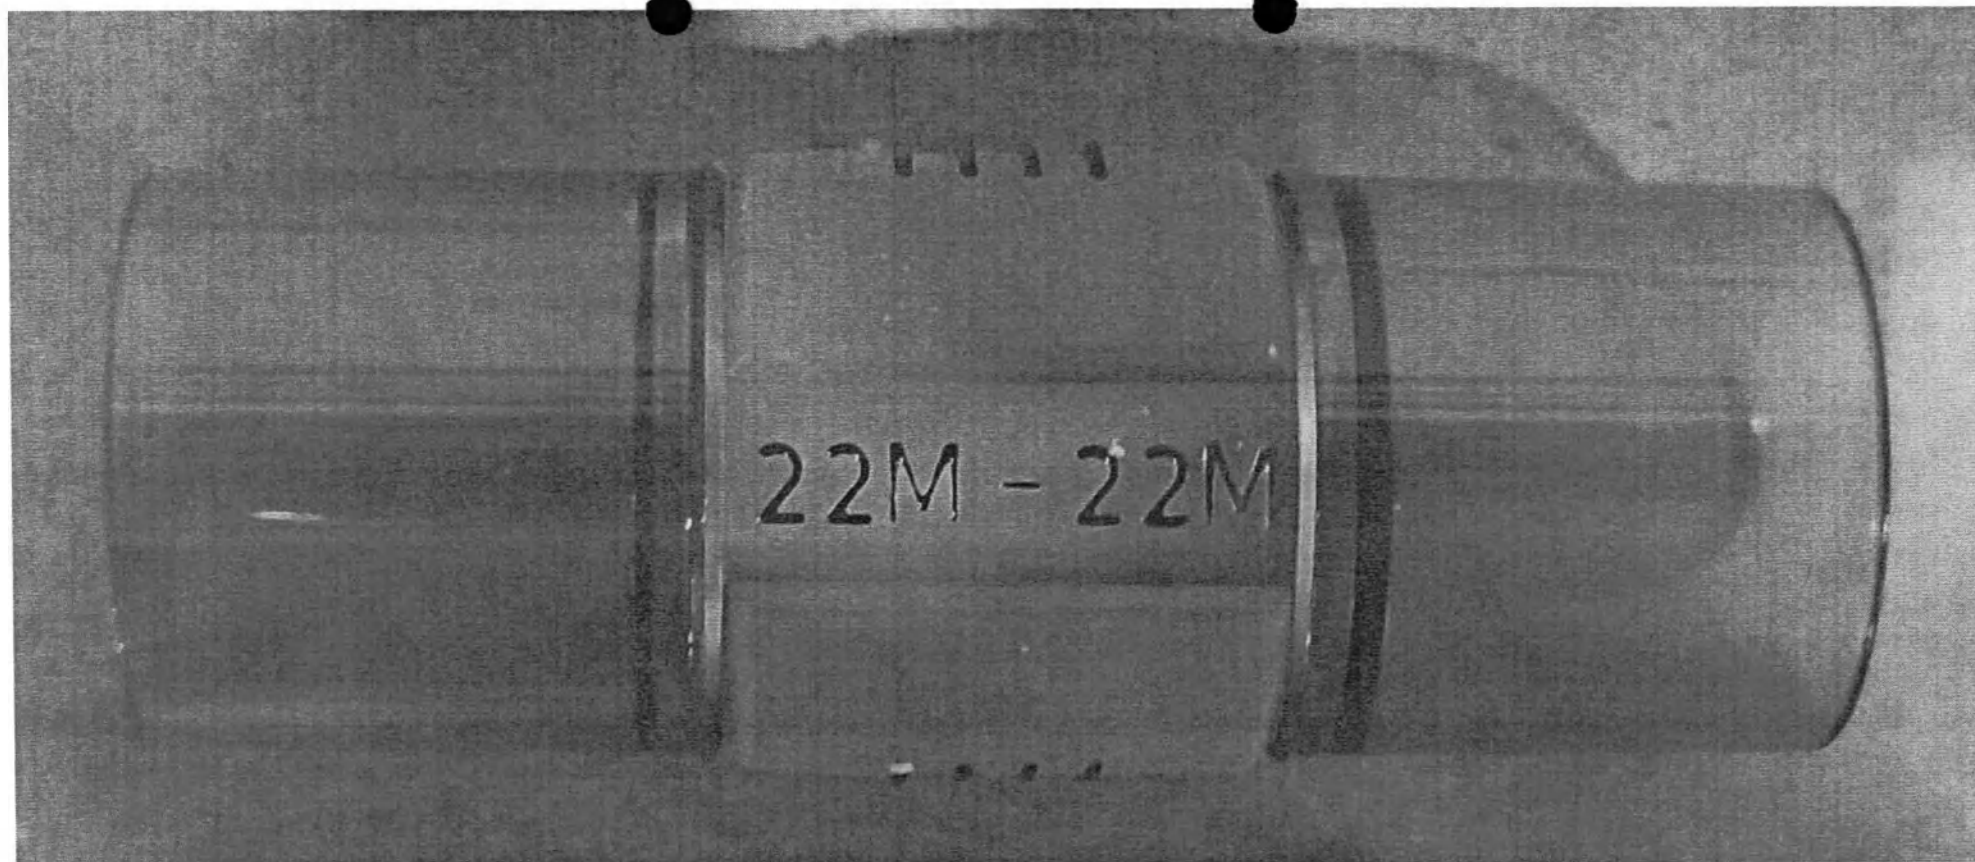


20 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель без портов и линий мониторинга: жесткий; прямой, 9110000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)



21 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1944000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

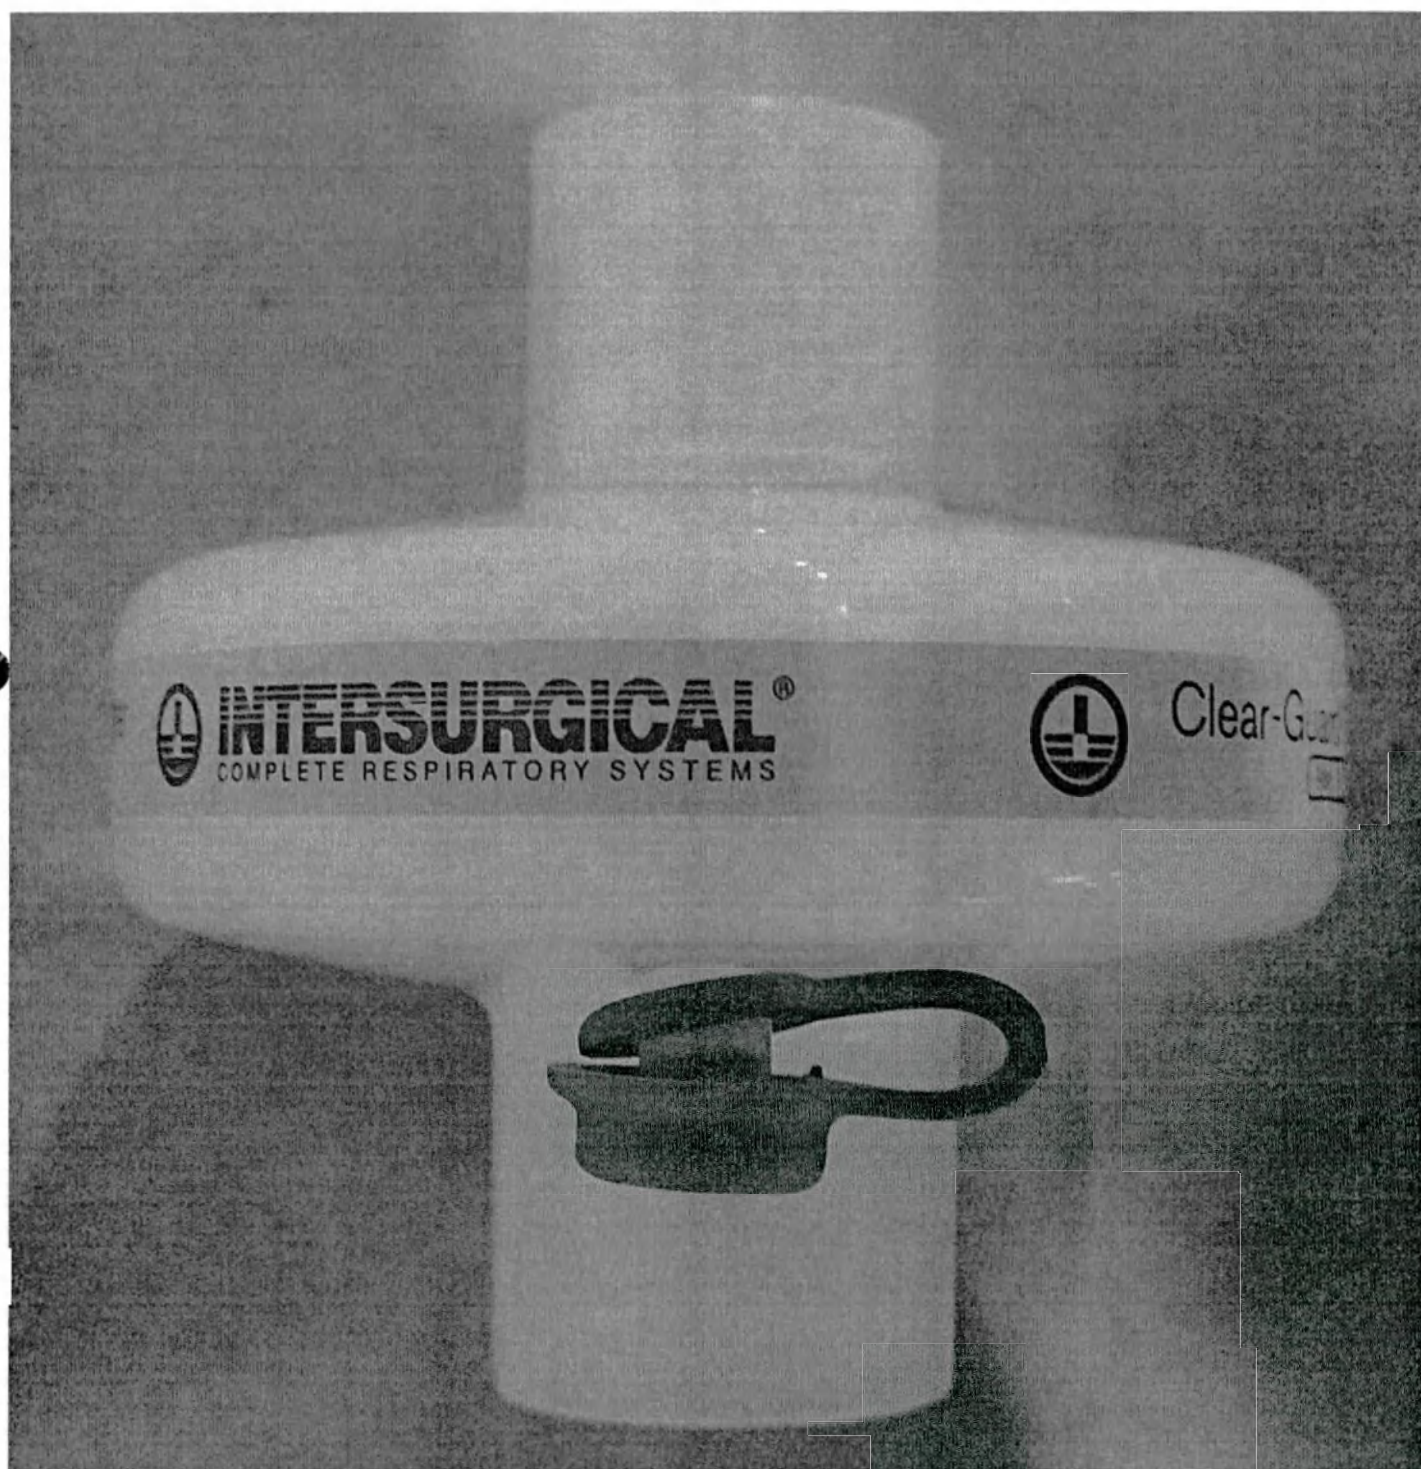


21 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1544000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

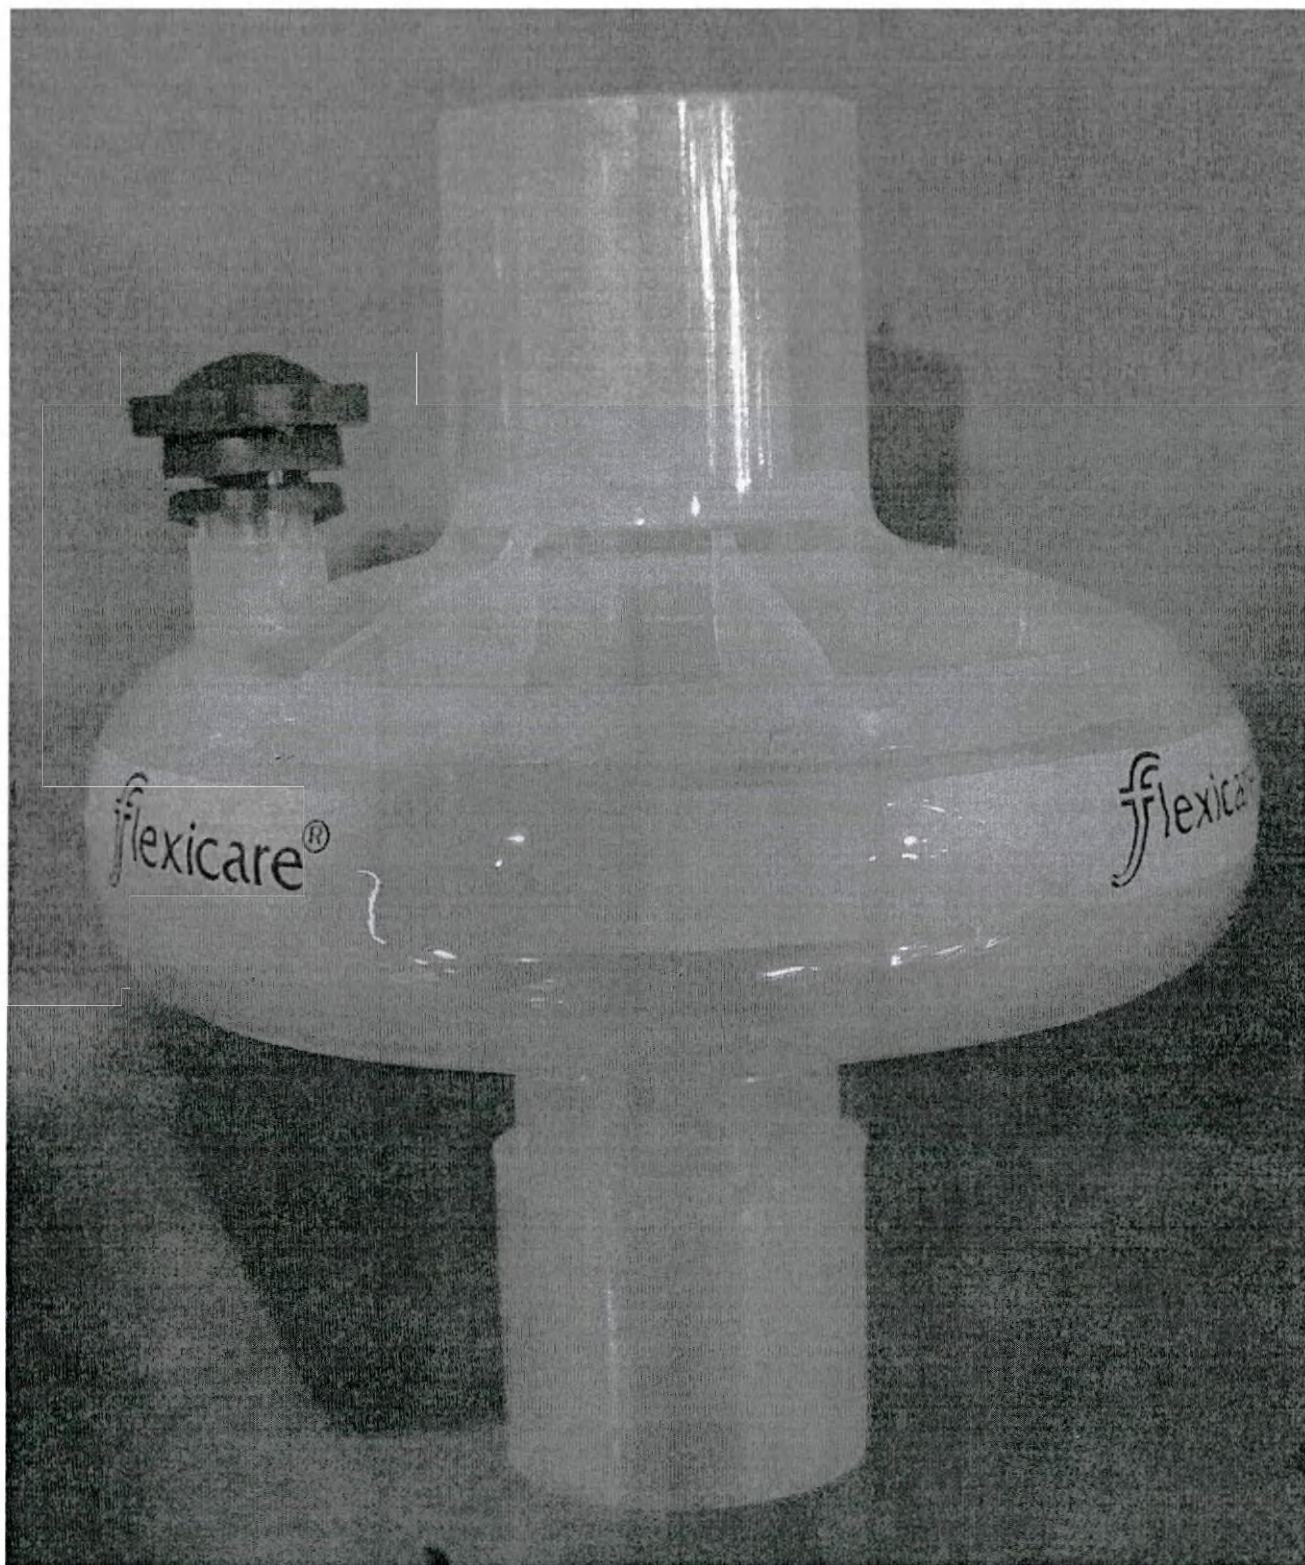

21 Фильтр дыхательный бактерицидный взрослый одноразовый, 038-41-365, Flexicare Medical Limited, Великобритания



21 Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22 F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock, FI30111, РУ № РЗН 2018/7282, ООО «Ассомедика», Беларусь

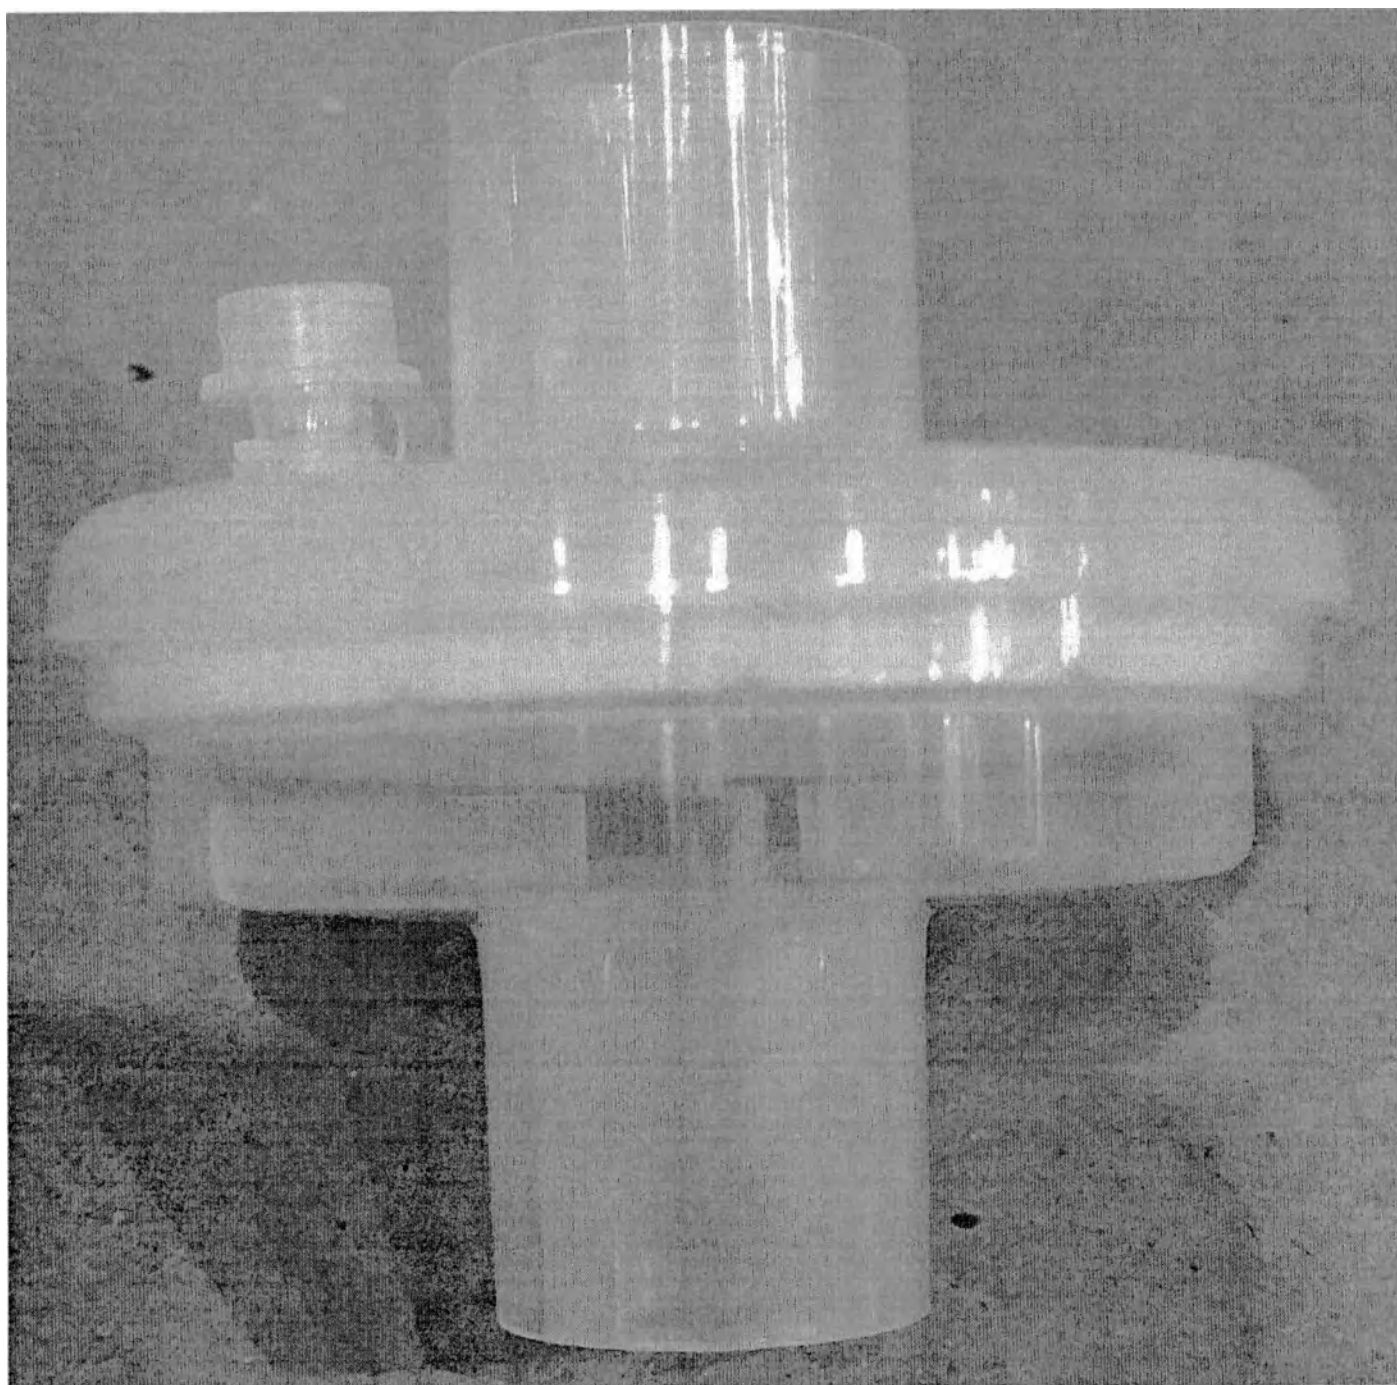


21 Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, варианты исполнения: Фильтр электростатический: Е001, 9110000, РУ № ФСР 2011/11397, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия




**21 Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной
...рации по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, варианты исполнения: Фильтр электростатический: Е101, 9120000, РУ
№ ФСР 2011/11397, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия**




22 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии:
дыхательный вирусно-бактериальный фильтр: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1644000,
РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

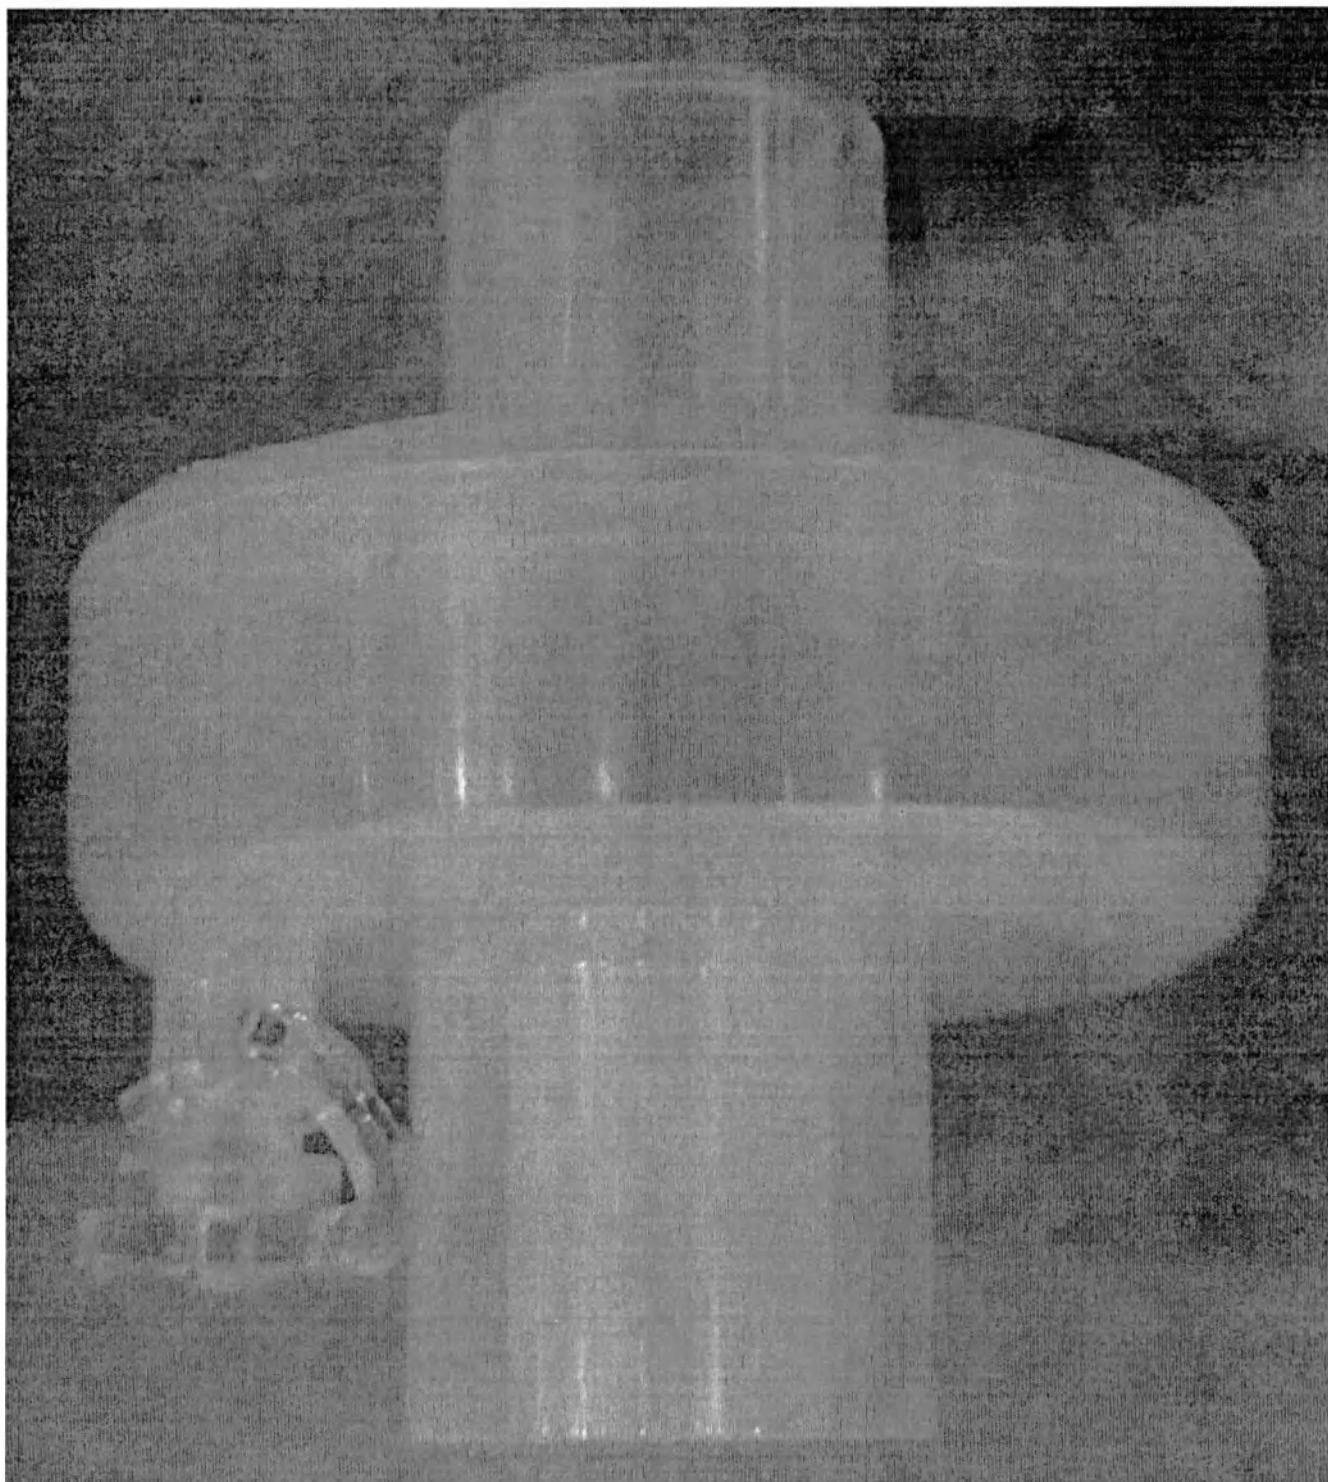

22 Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22 F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock, FI20111, РУ № РЗН 2018/7282, ООО «Ассомедика», Беларусь

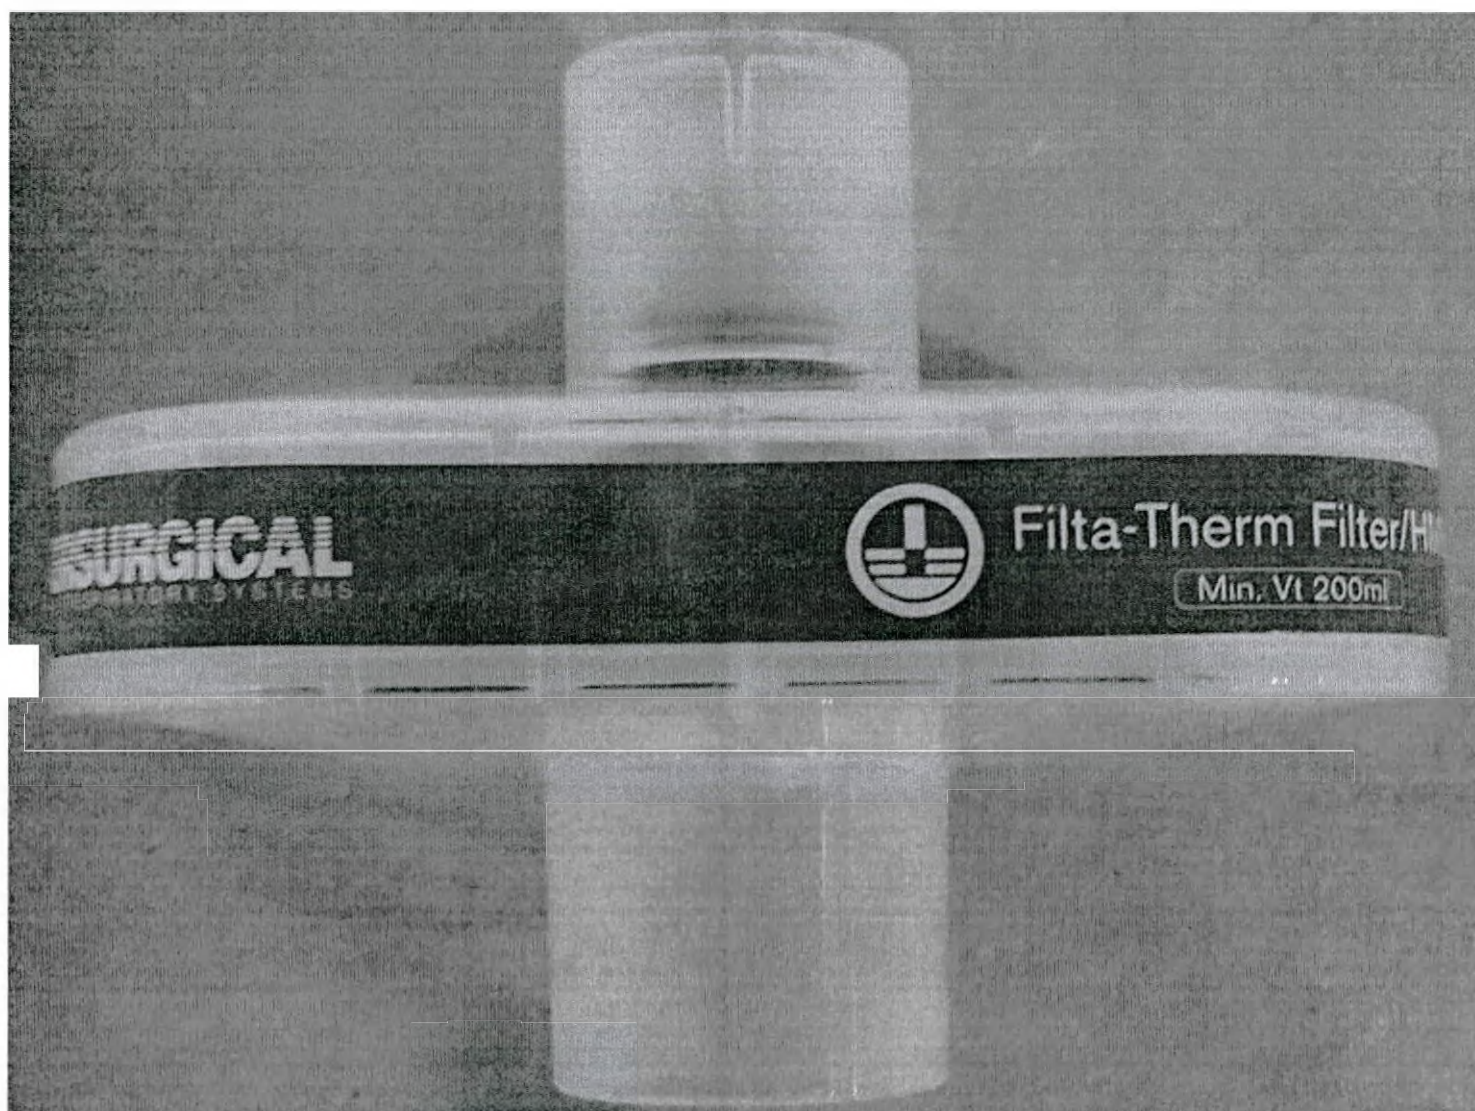


23 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр - теплообменник: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1942000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

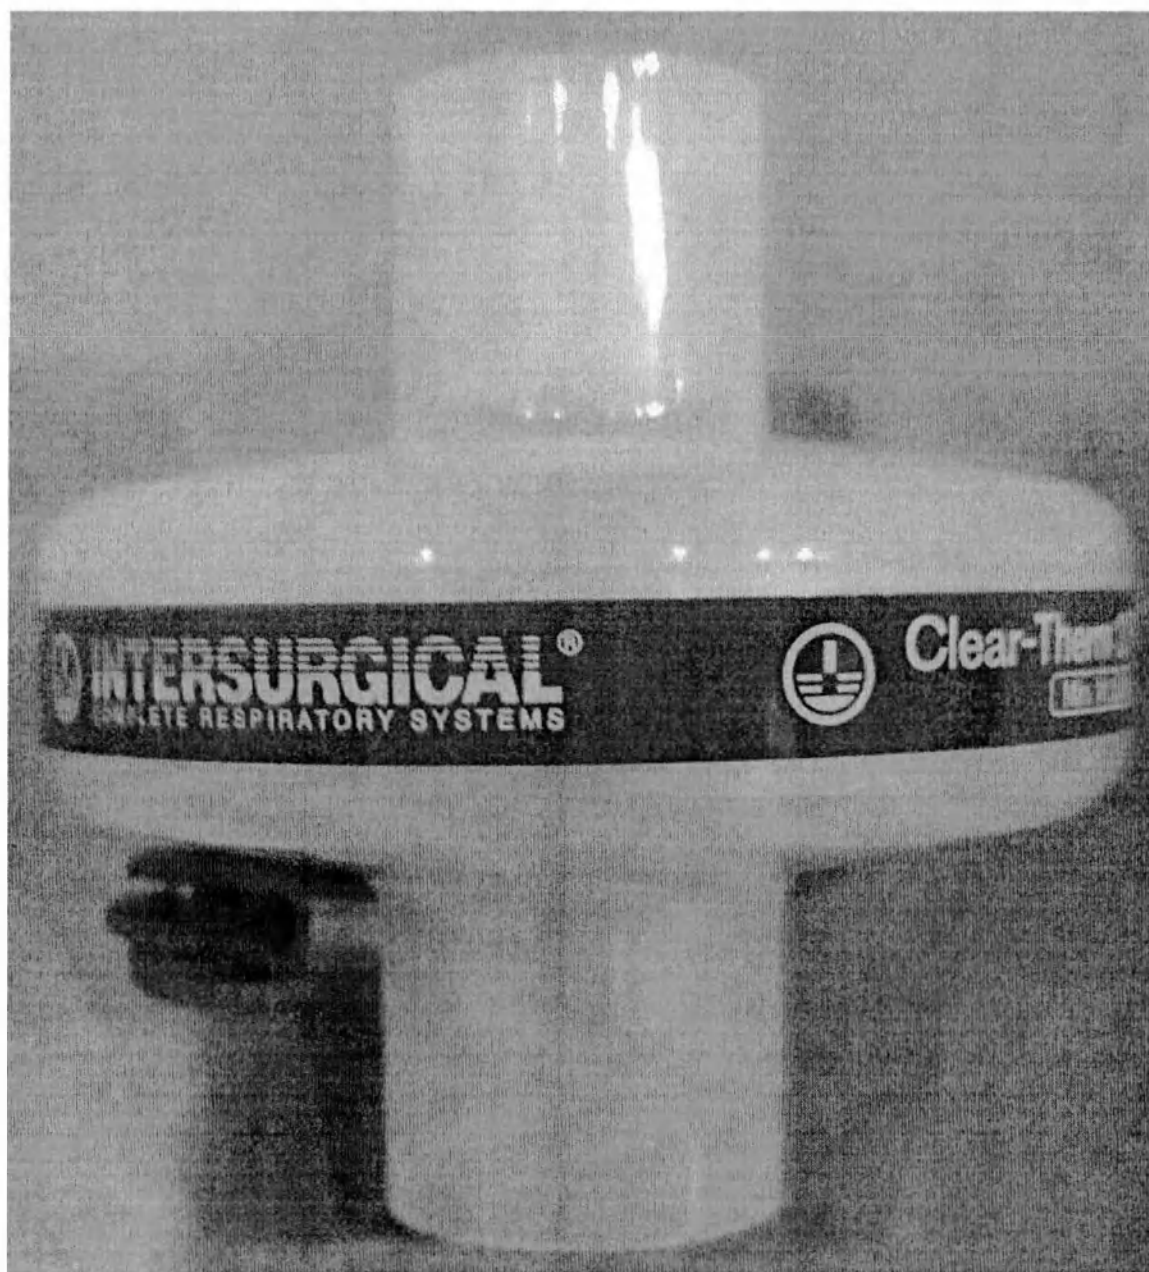


23 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр - тепловлажгообменник: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1541000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)



**23 Фильтр дыхательный бактерицидный с тепловлажнотенником взрослый одноразовый, 038-41-355,
Flexicare Medical Limited, Великобритания**

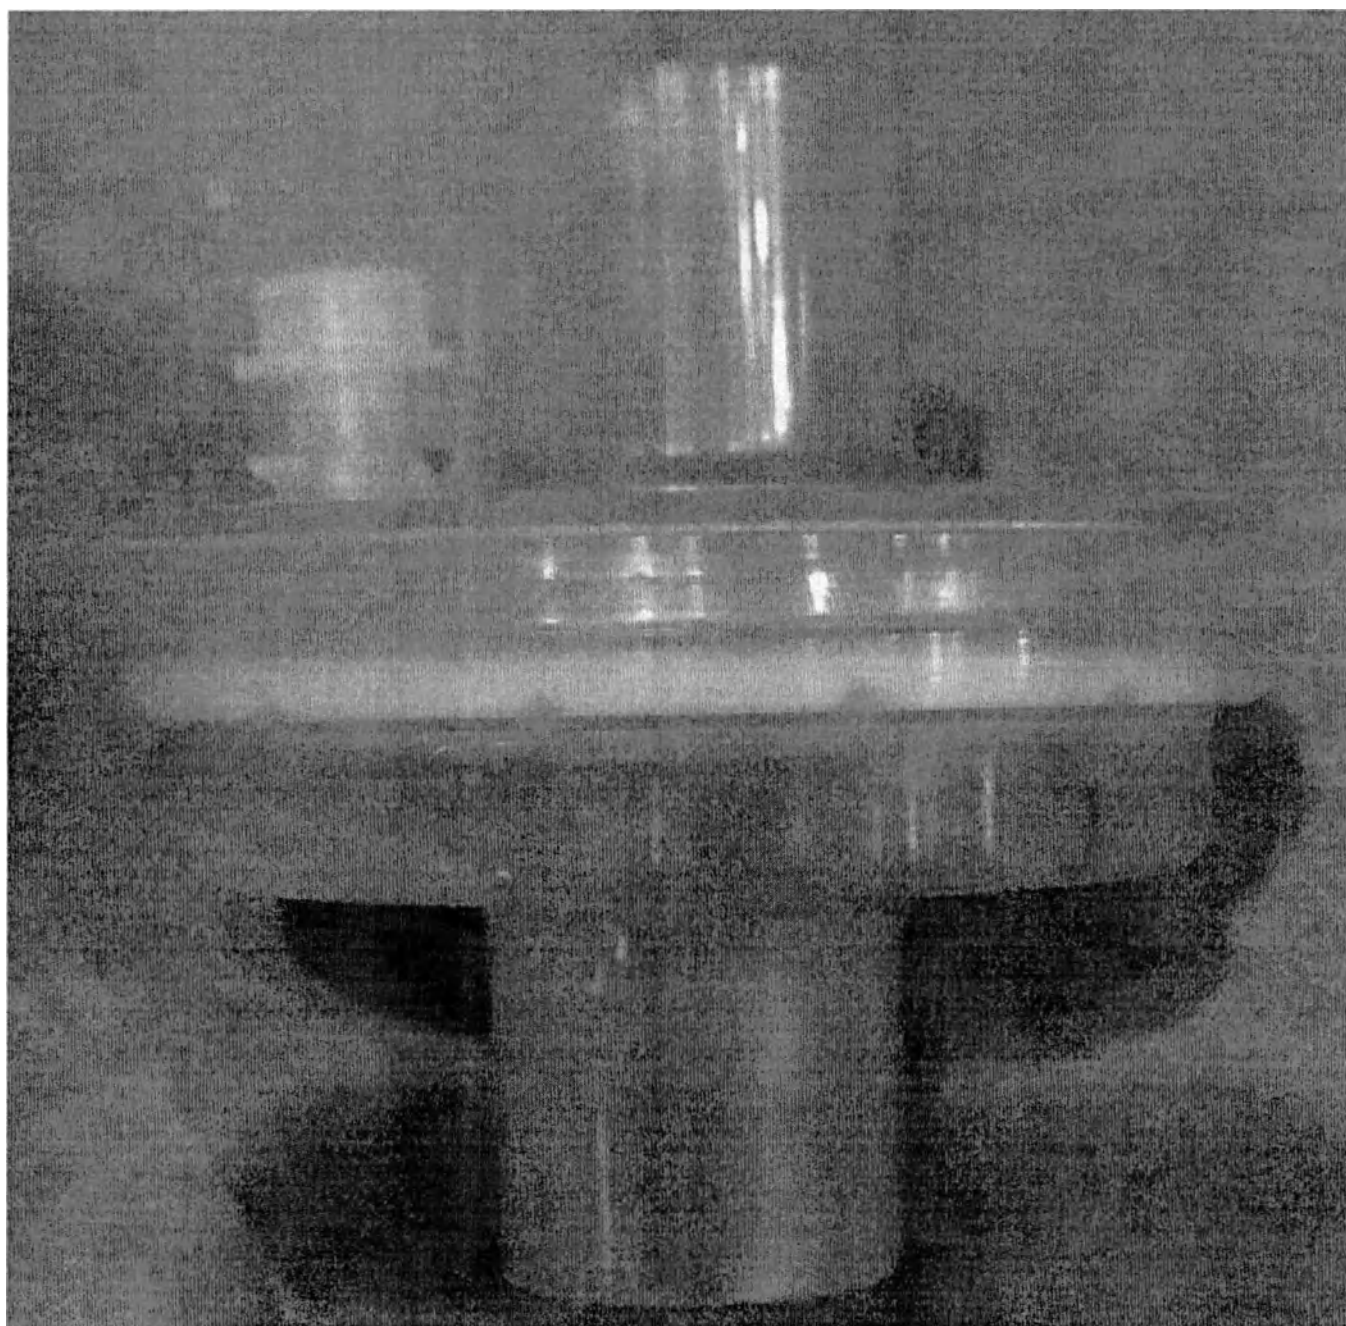


23 Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, варианты исполнения: Фильтр электростатический теплооблагодотенный в моделях: ET100, 9610000, РУ № ФСР 2011/11397, АО «НПД «ИНТЕРОКО», Россия

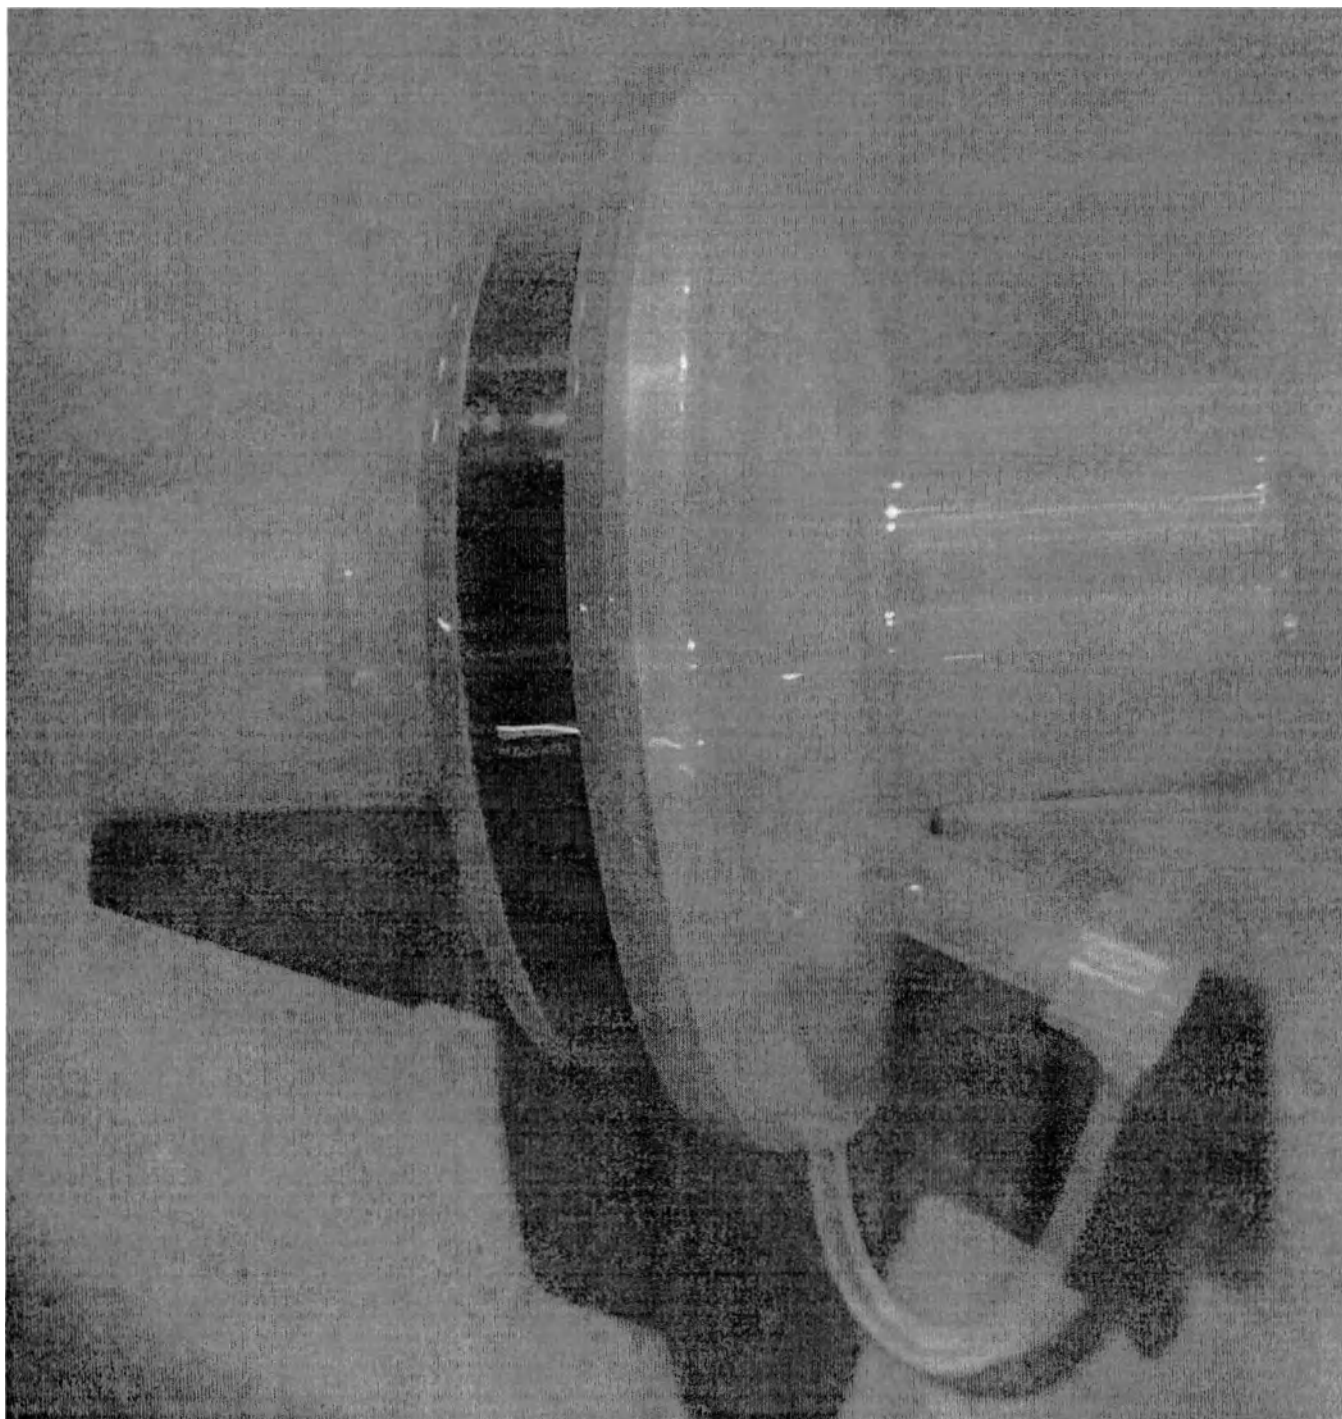


23 Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, варианты исполнения: Фильтр электростатический теплооблагоденный в моделях: ET111, 9320000, РУ № ФСР 2011/11397, АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия




23 Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22 F, с теплообменом, с портом luer-lock, FI31111, РУ № РЗН 2018/7282, ООО «Ассомедика», Беларусь

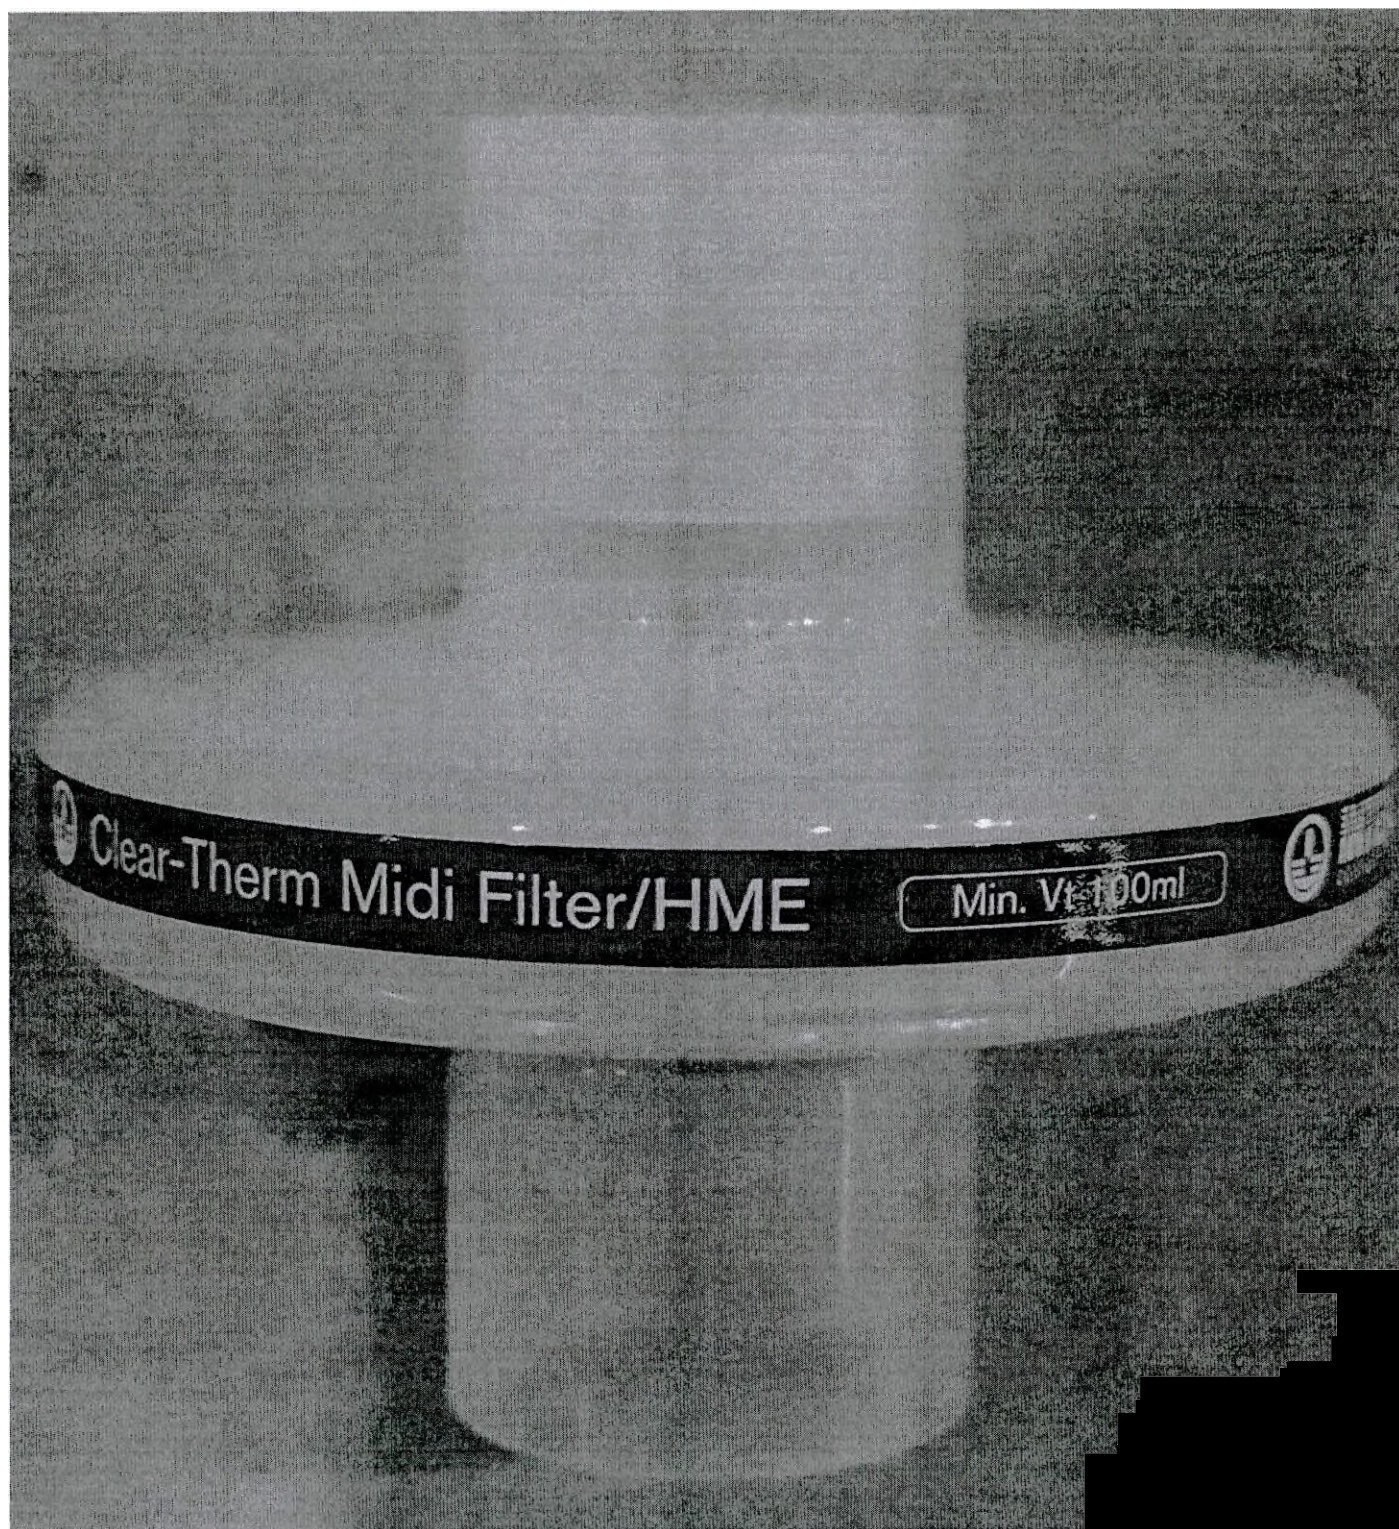


24 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр - теплообменник: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 1641000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

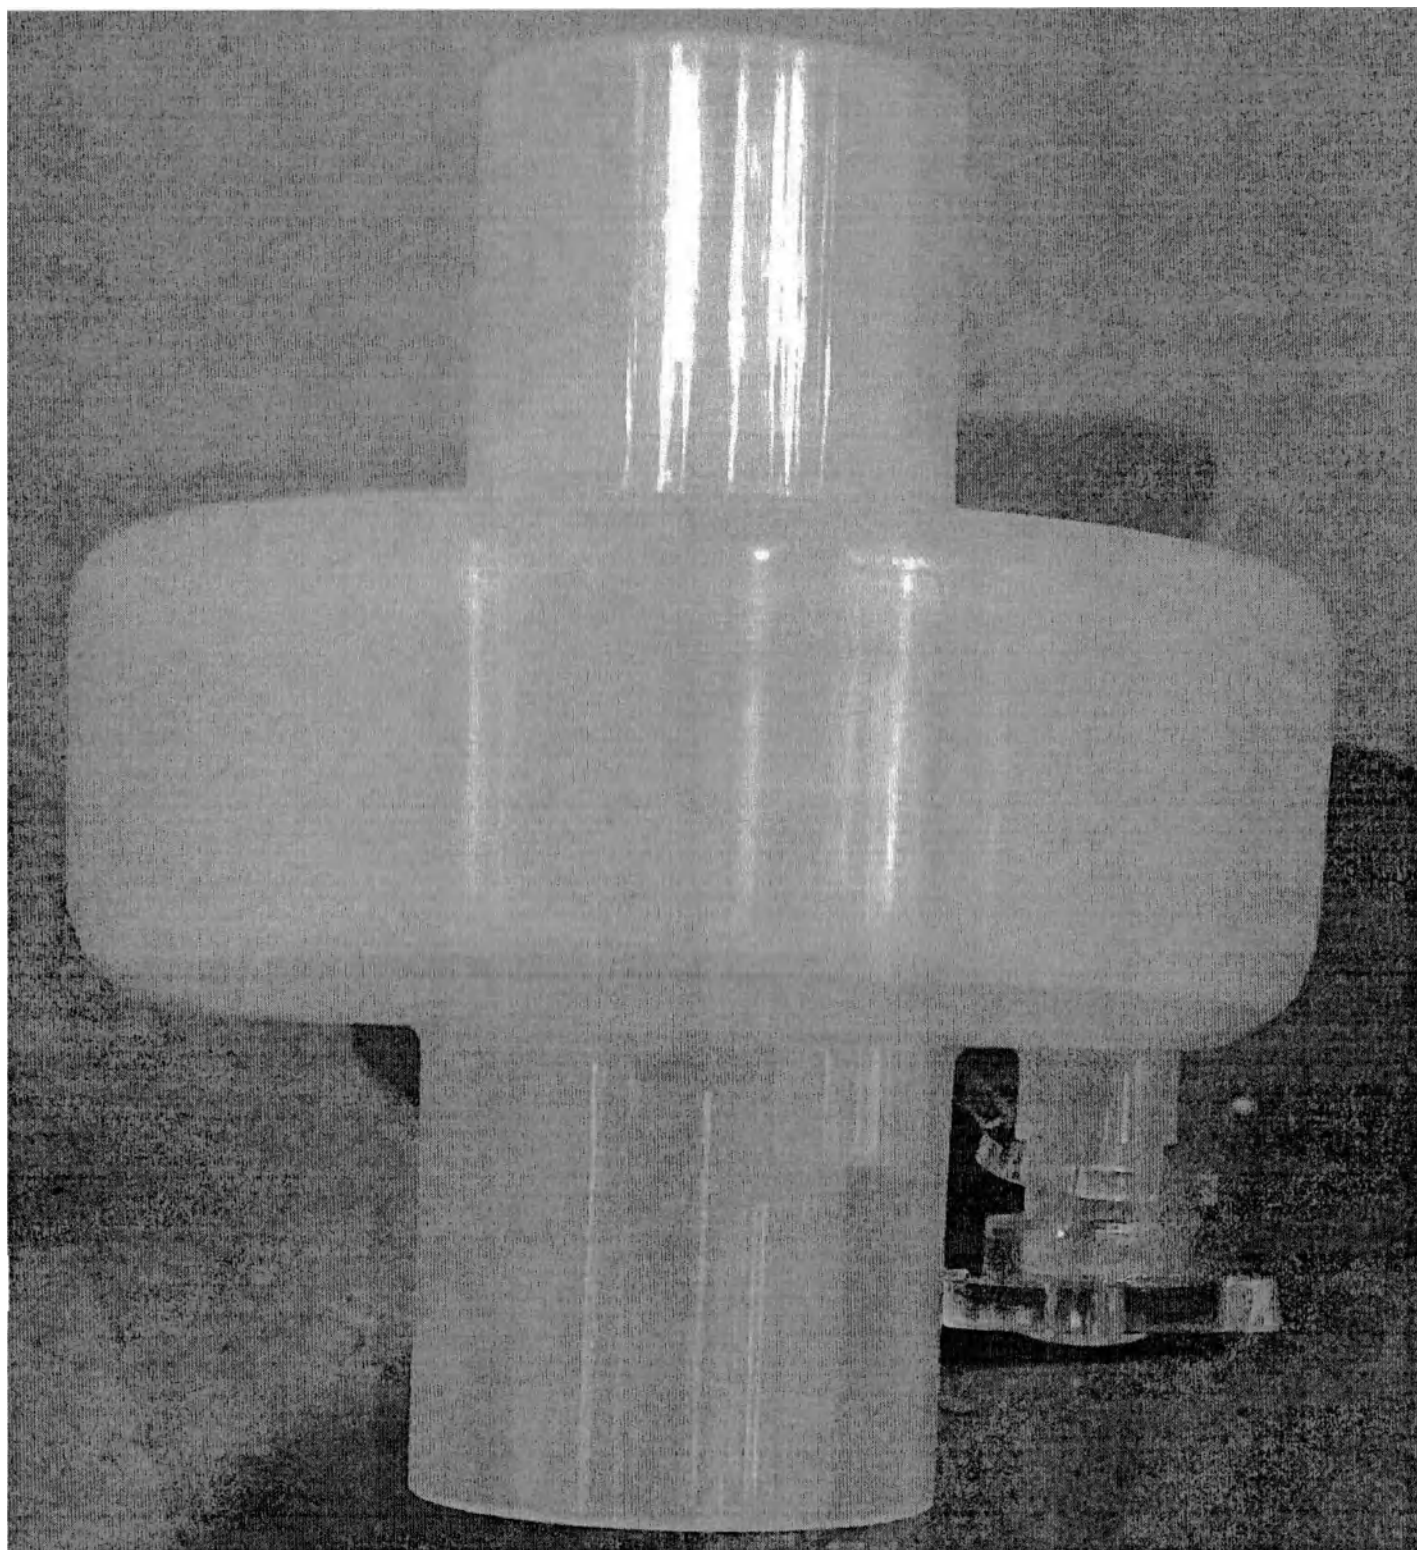


24 Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22 F, с теплообменом, с портом luer-lock, FI21111, РУ № РЗН 2018/7282, ООО «Ассомедика», Беларусь

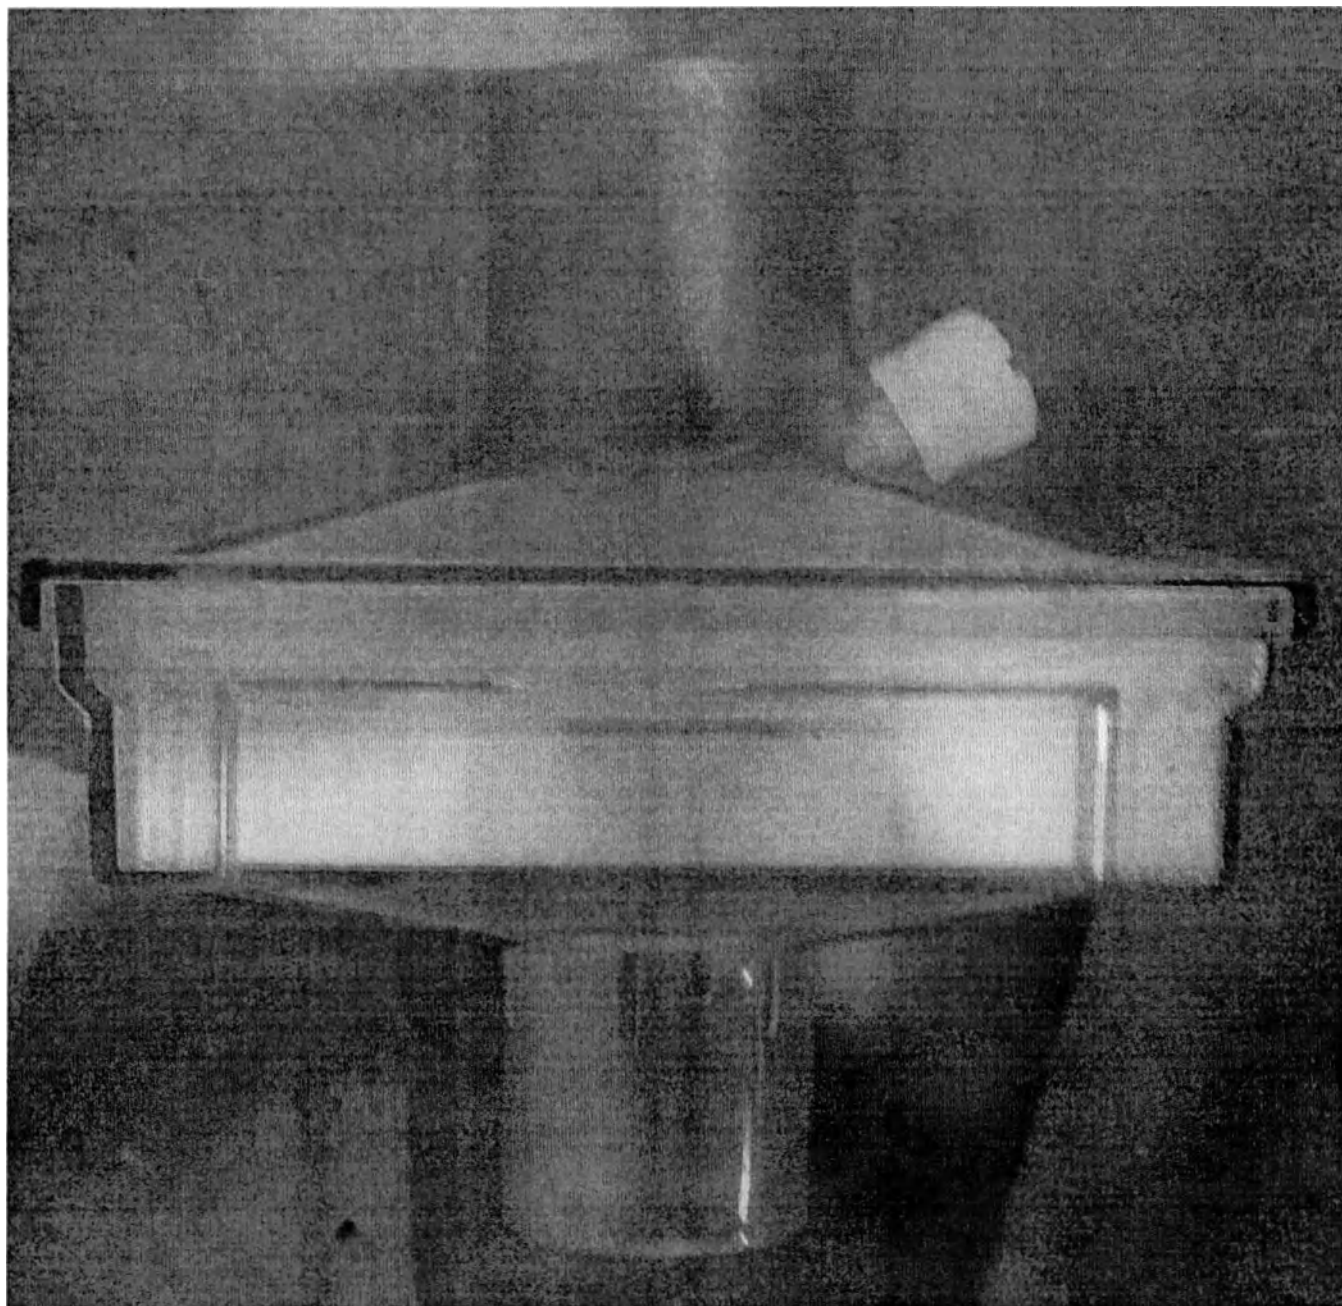


**25 Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких. Фильтры механические, 351U5878 (351/5878),
РУ № ФСЗ 2011/11170, «Ковидиен Лтс», США (Covidien Llc)**

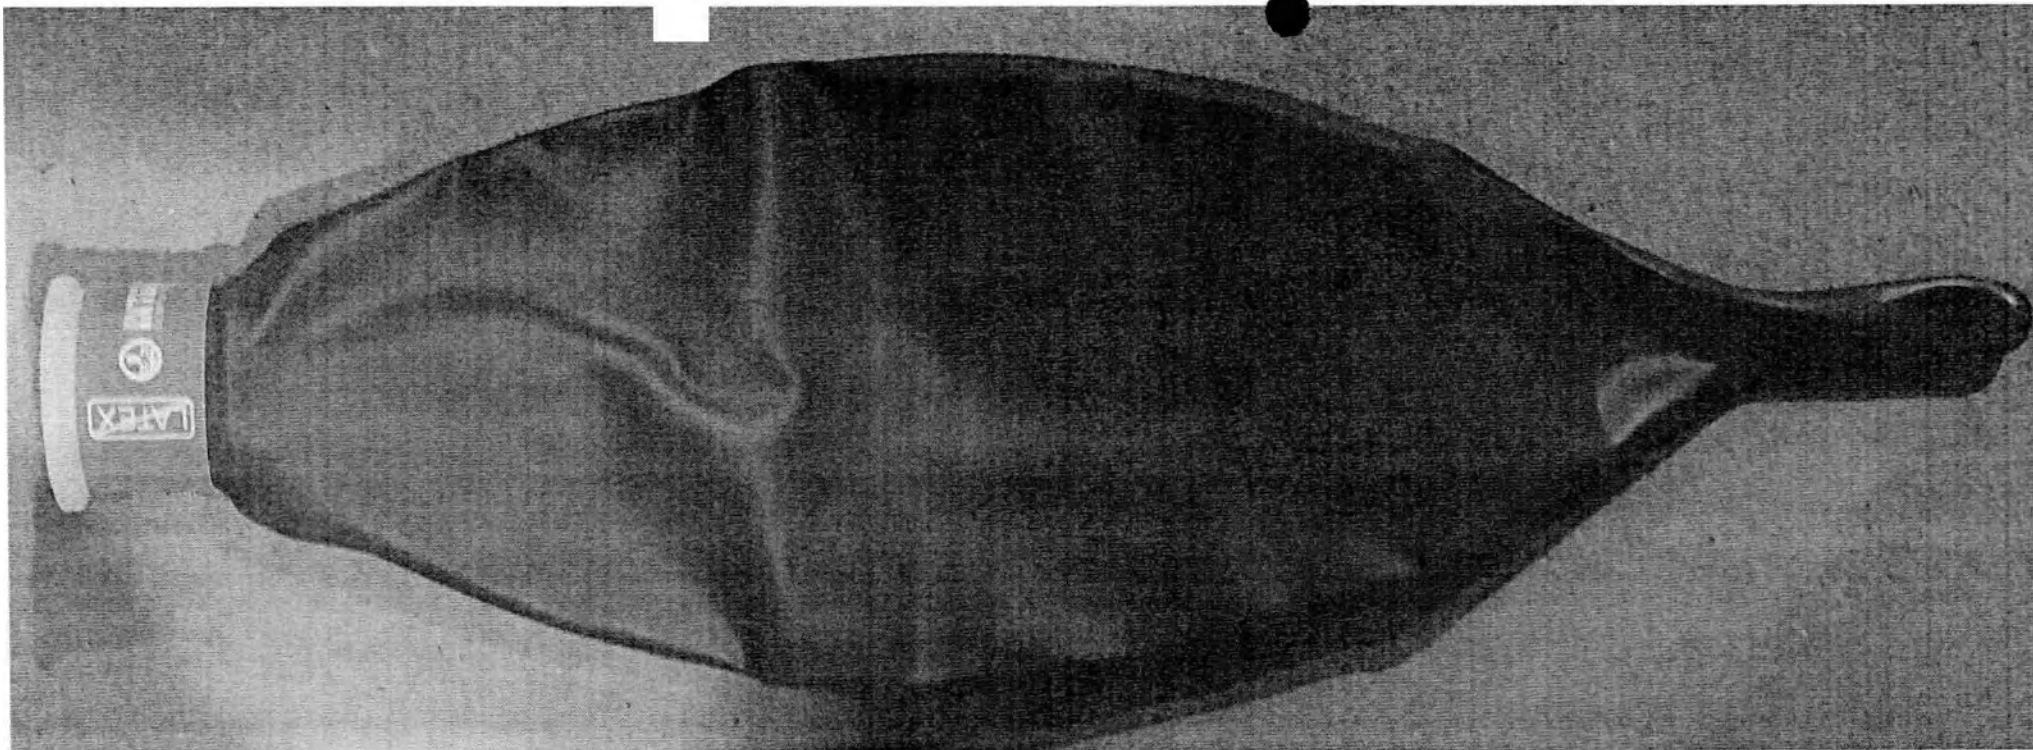


26 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный мешок объёмом: 0,5л, 2805000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

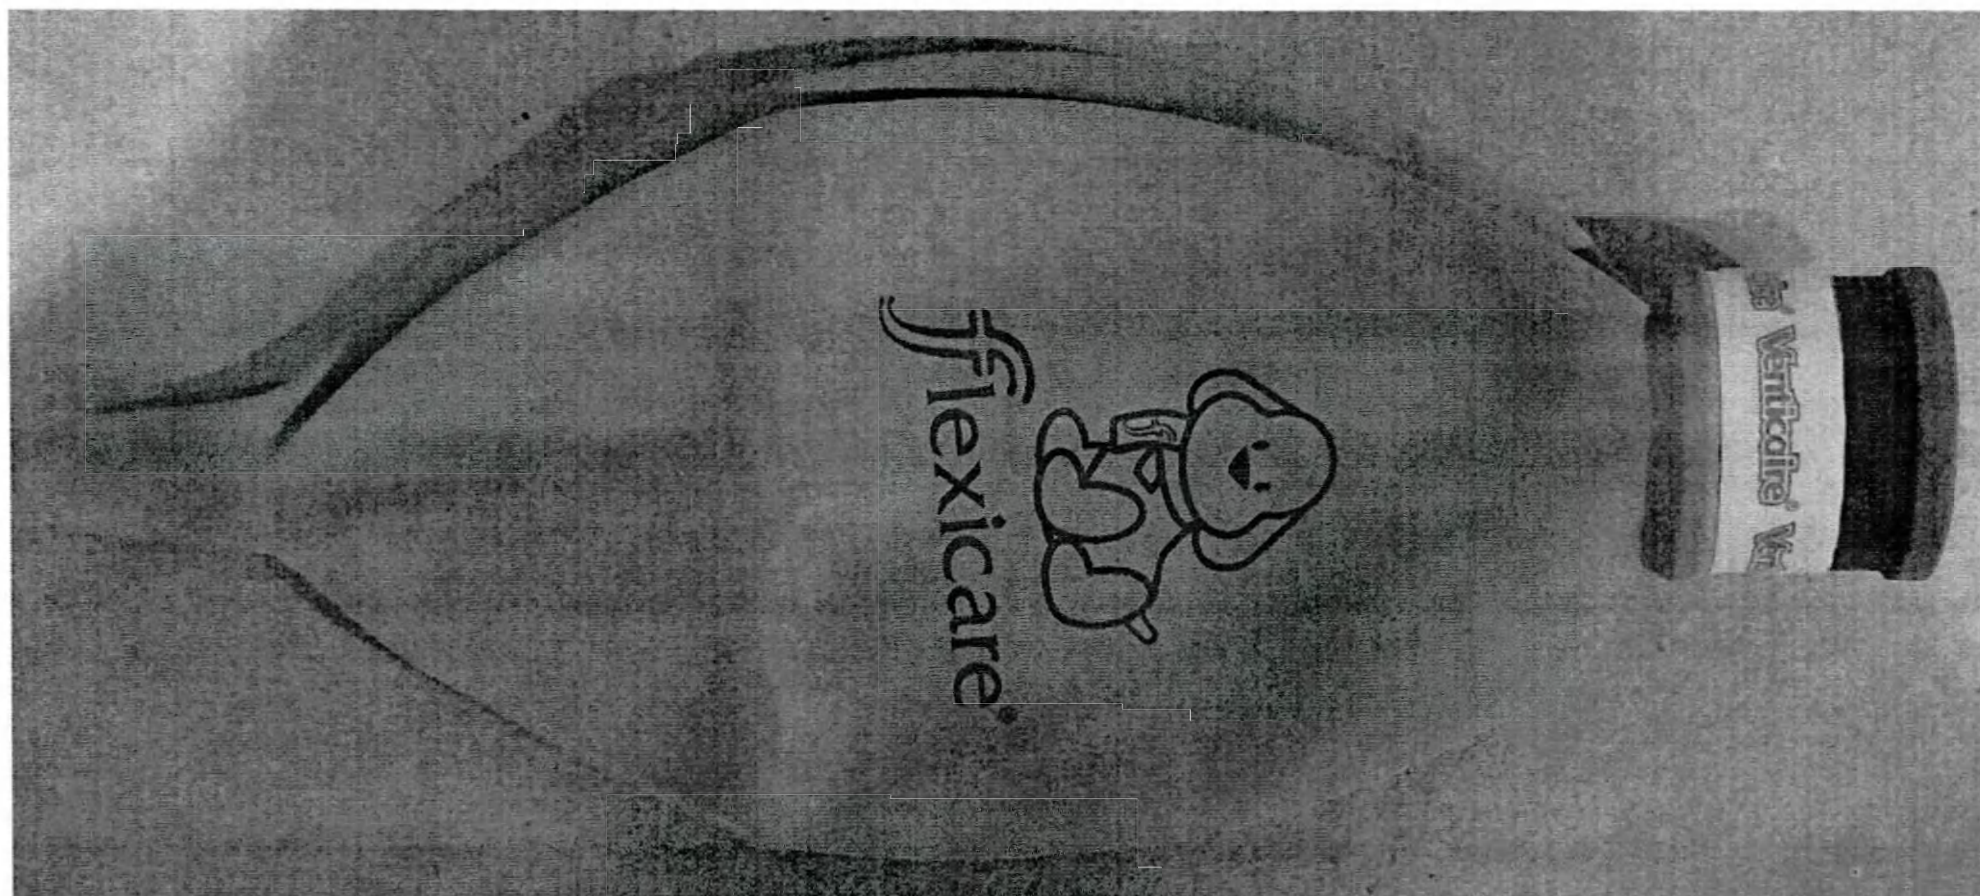


26 Мешок резервный 0,5л, 038-83-805NL, Flexicare Medical Limited, Великобритания

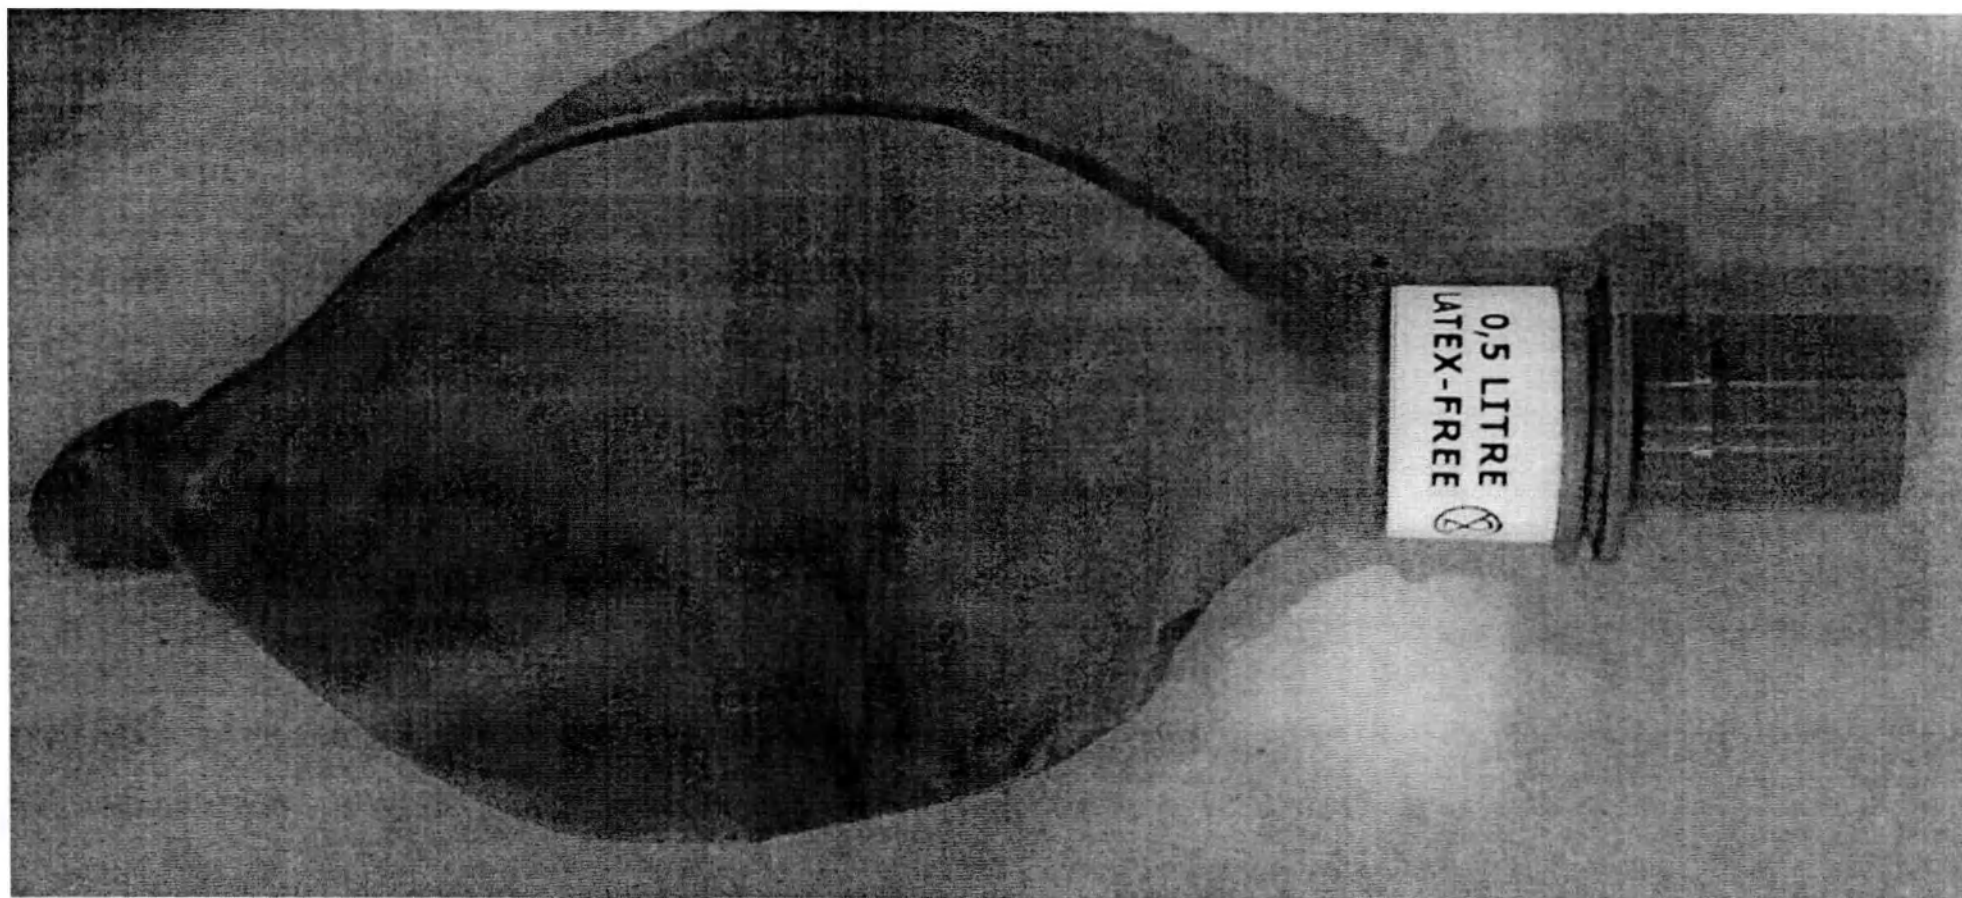


26 Мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл, BAG0.5, РУ № РЗН 2018/6773, ООО «Ассомедика», Беларусь

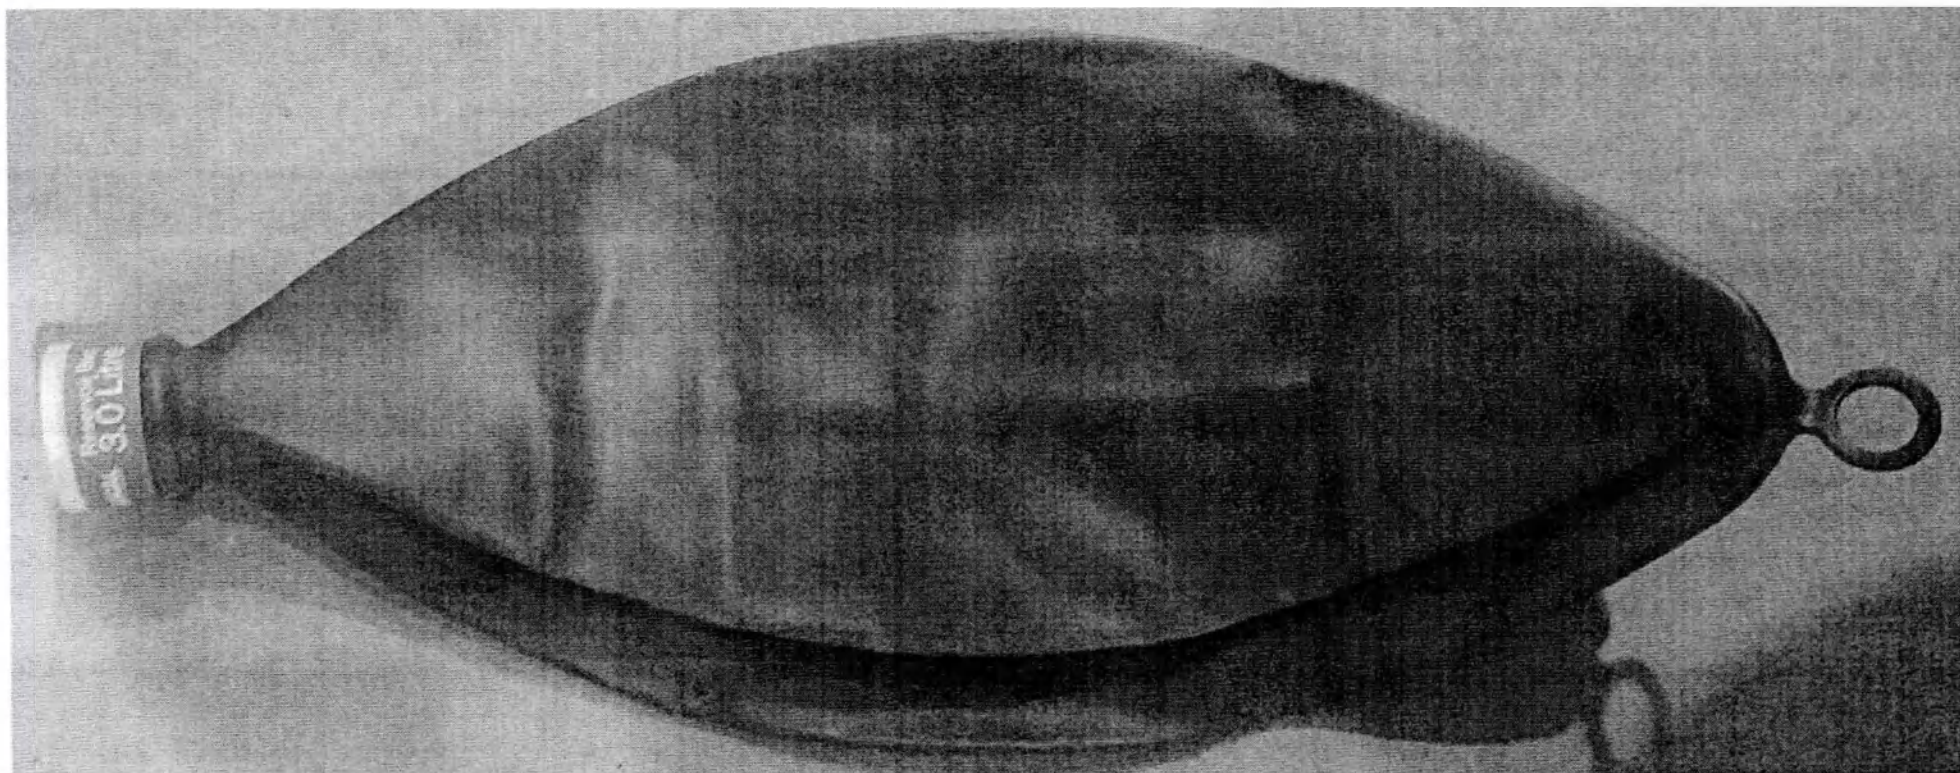


27 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный мешок объёмом: 3,0л, 2830000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

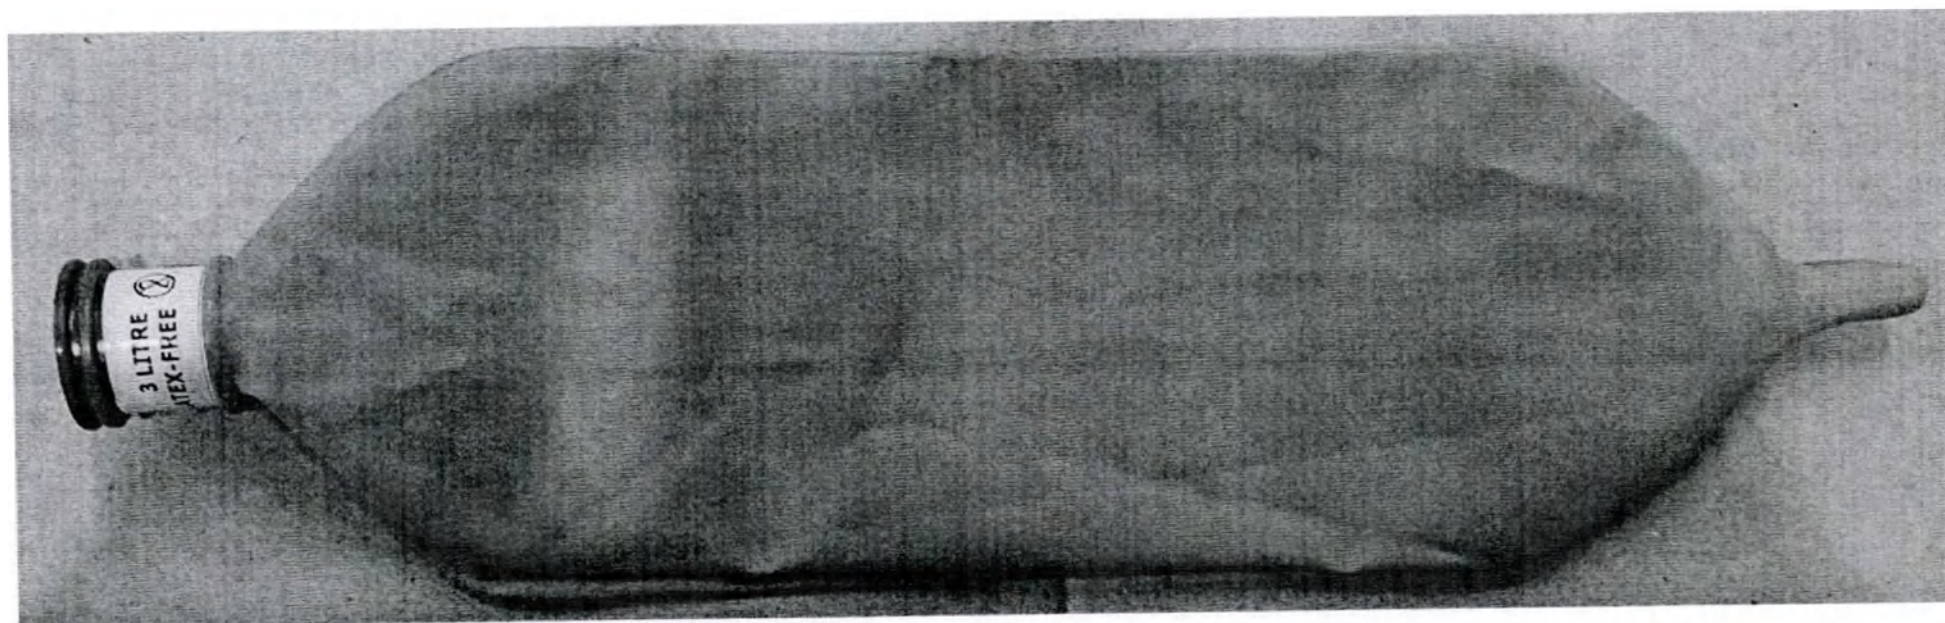


27 Мешок резервный 3л, 038-81-830NL, Flexicare Medical Limited, Великобритания

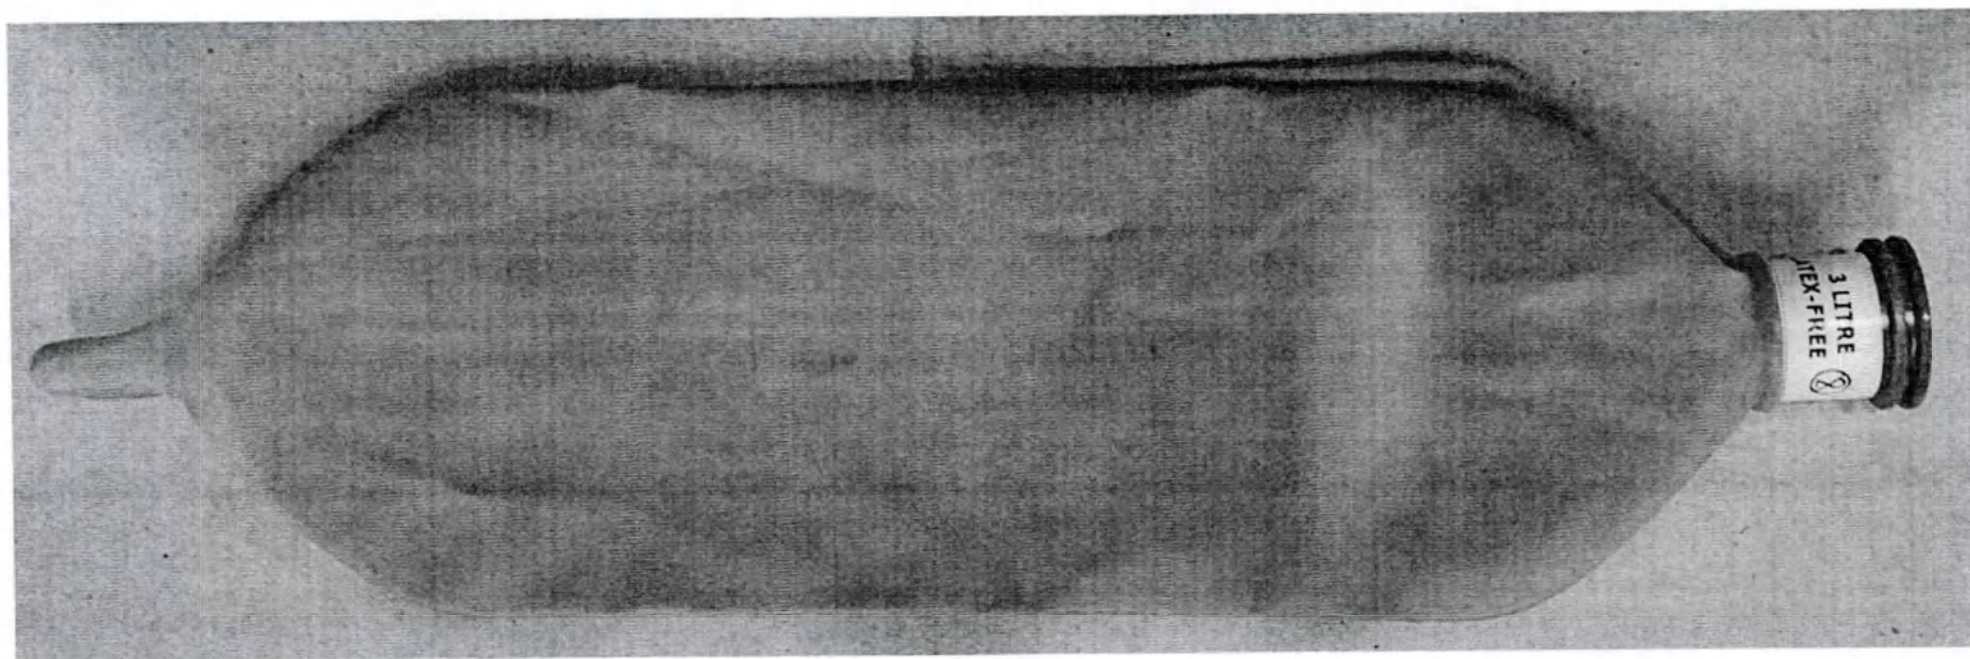


27 Мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл, BAG3, РУ № РЗН 2018/6773, ООО «Ассомедика», Беларусь

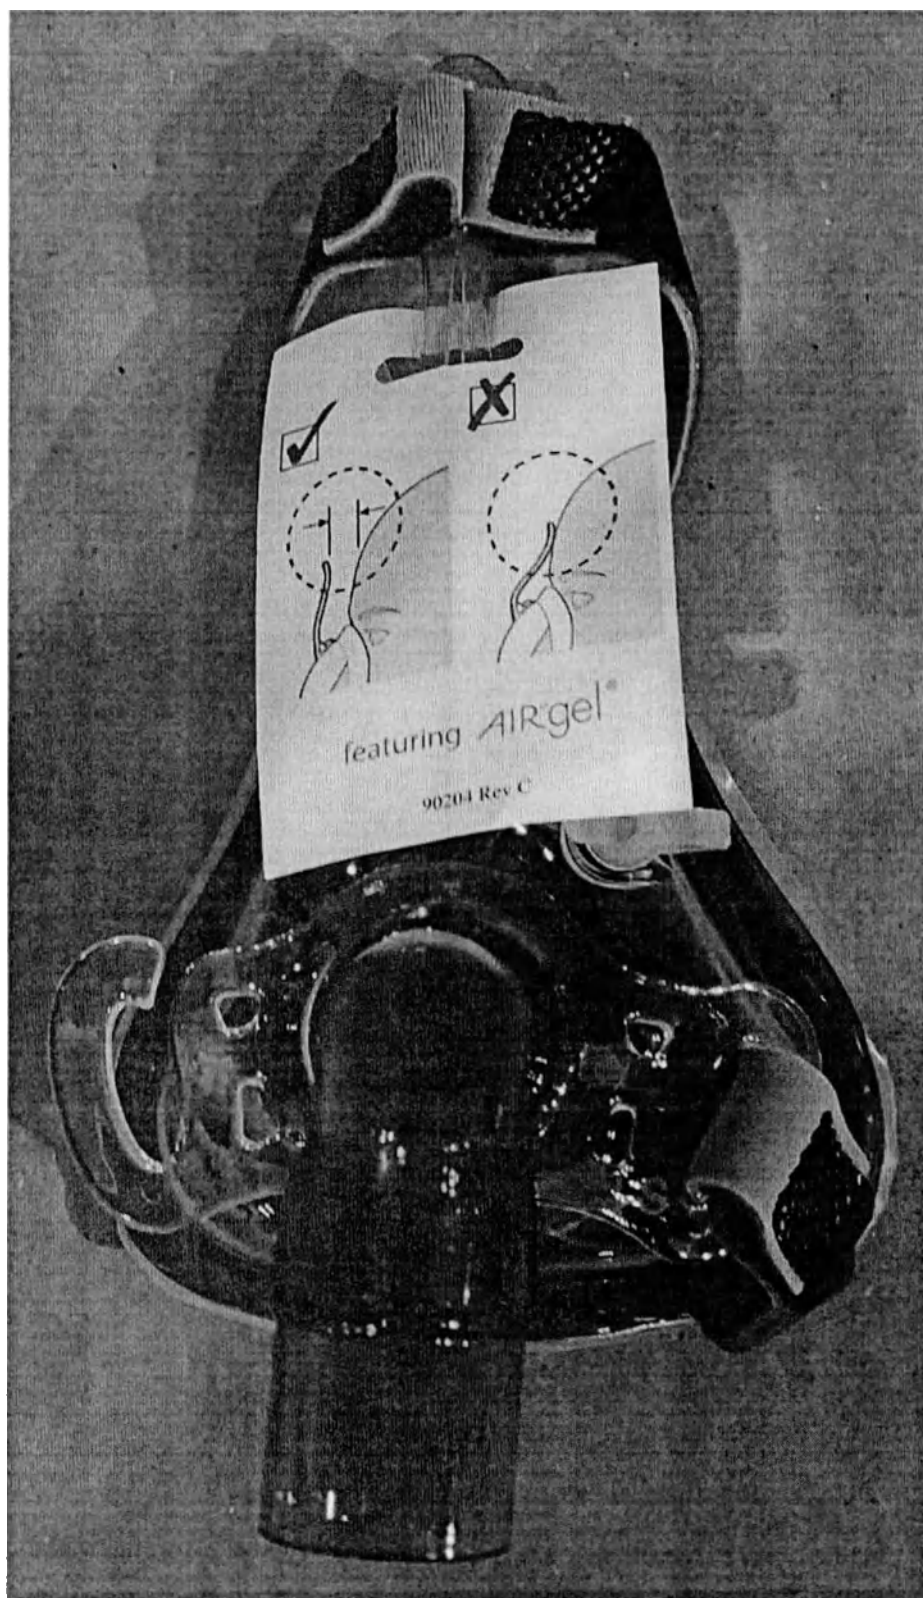


28 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для взрослых, размер S (малый), 2265000, маски для неинвазивной вентиляции, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

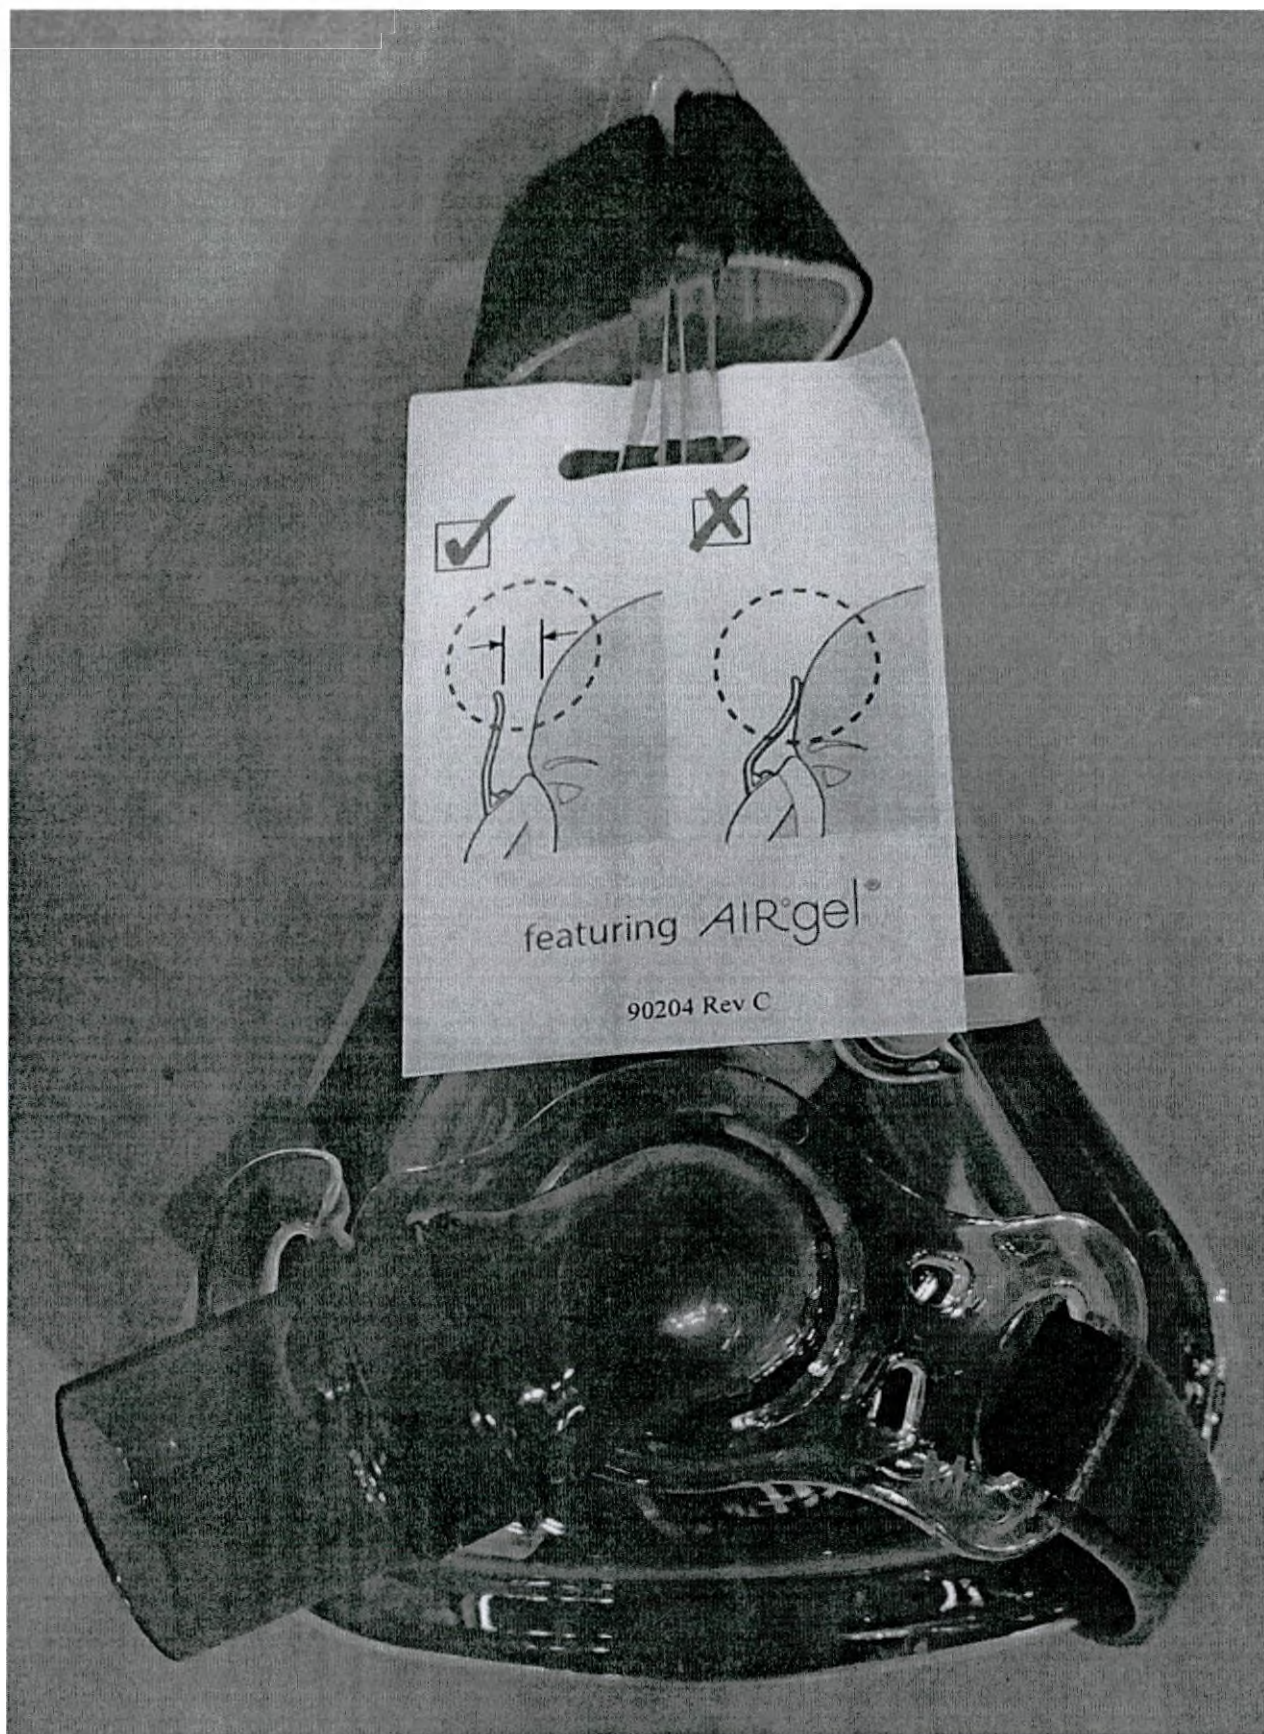


28 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для взрослых, размер М (средний), 2266000, маски для неинвазивной вентиляции, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

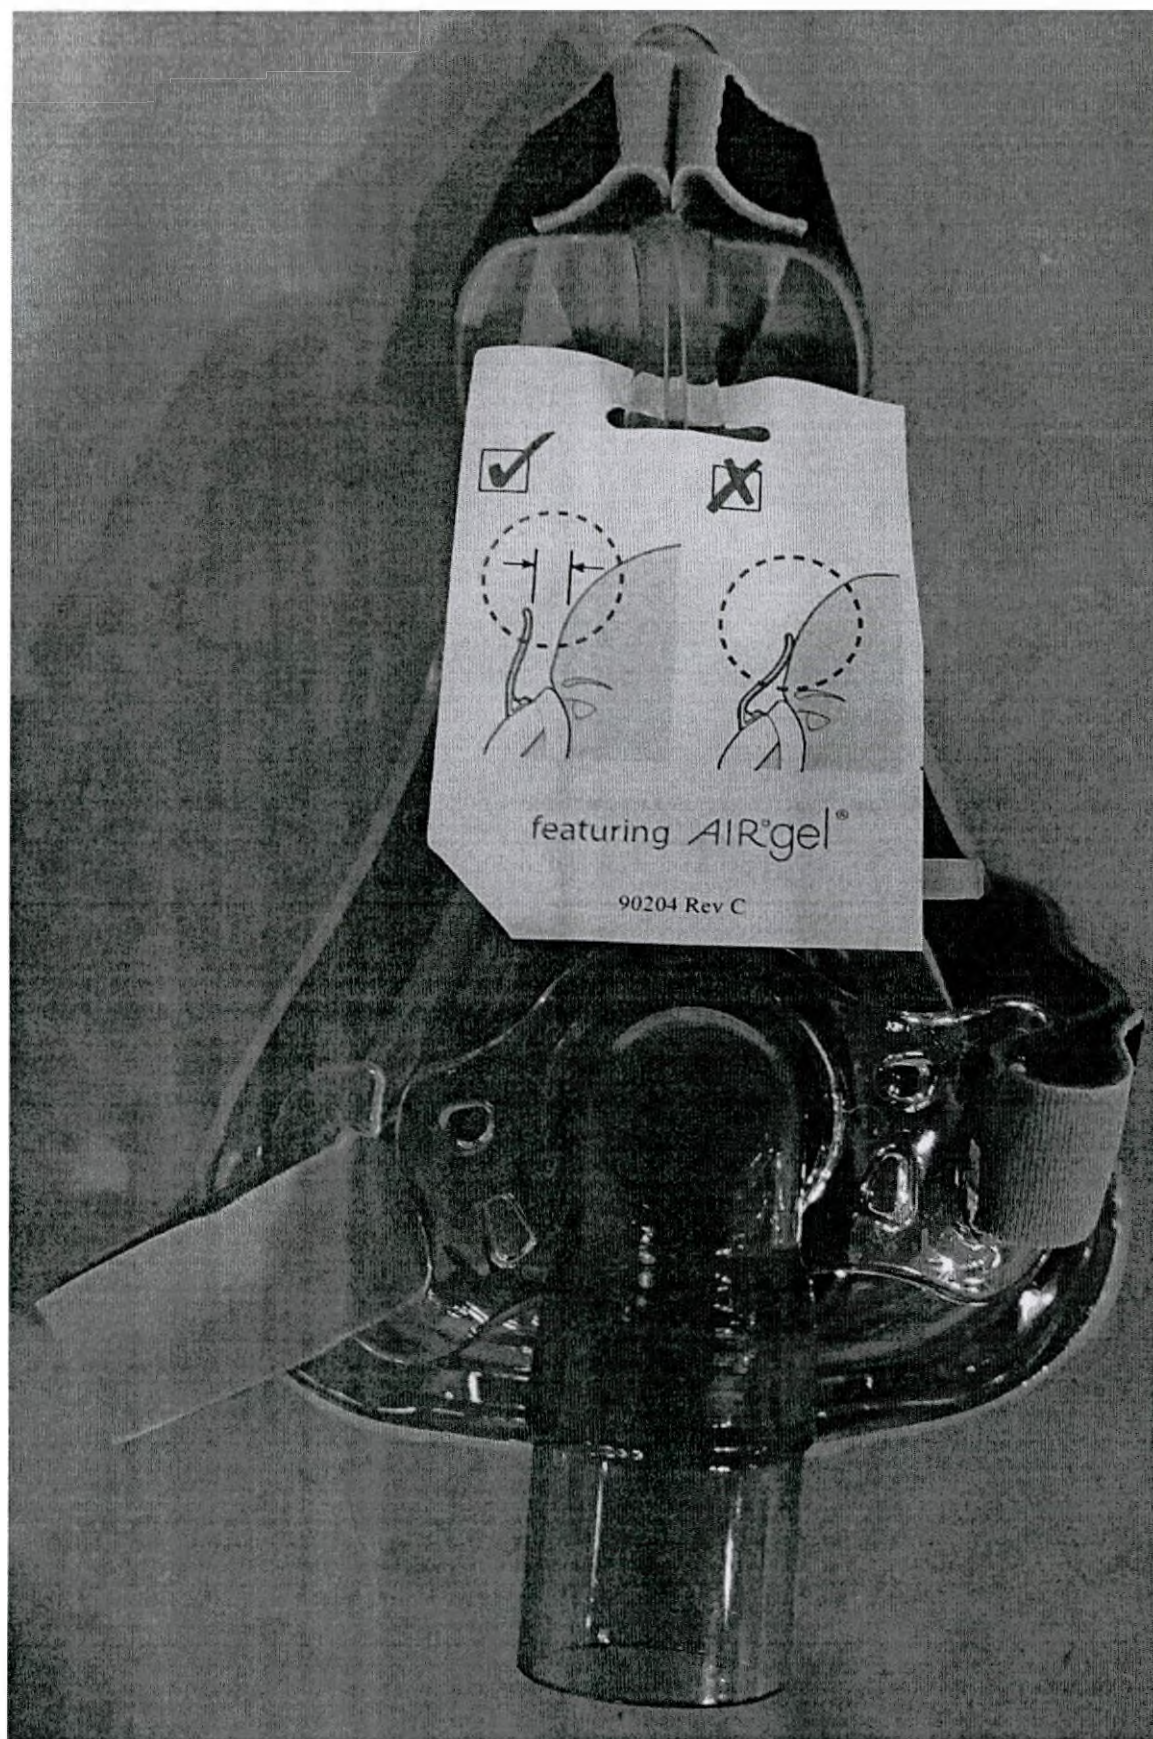


28 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для взрослых, размер L (большой), 2267000, маски для неинвазивной вентиляции, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd)

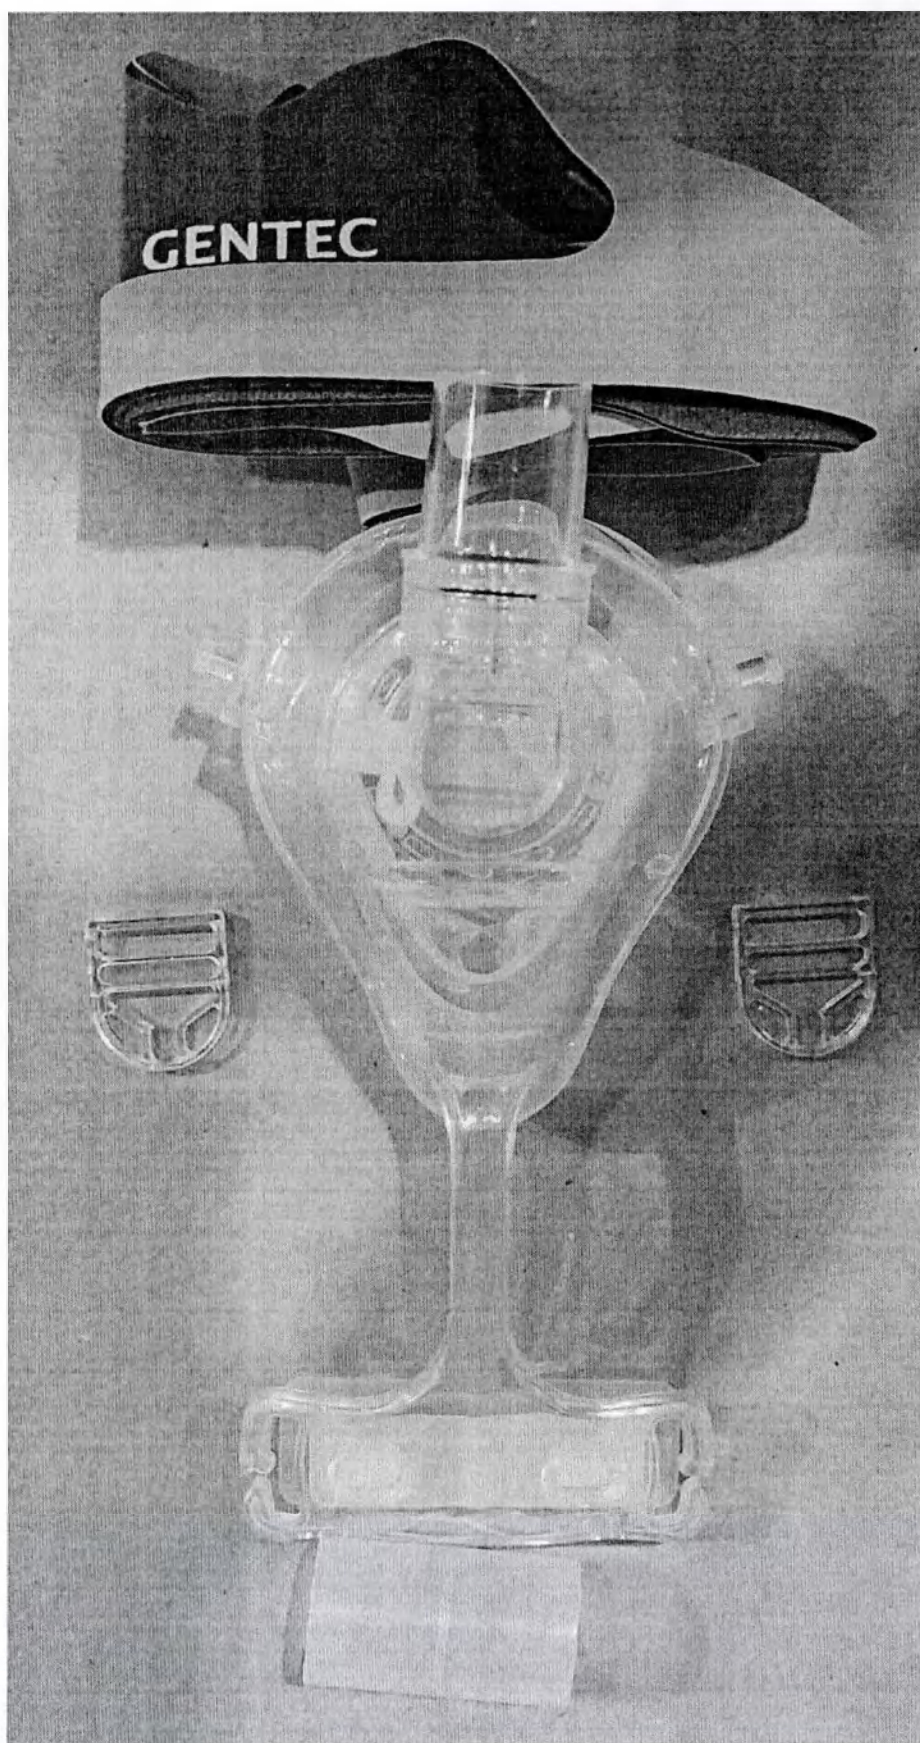


29 Маска NIV Full Face Respire: размер S, 641-009-NS, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

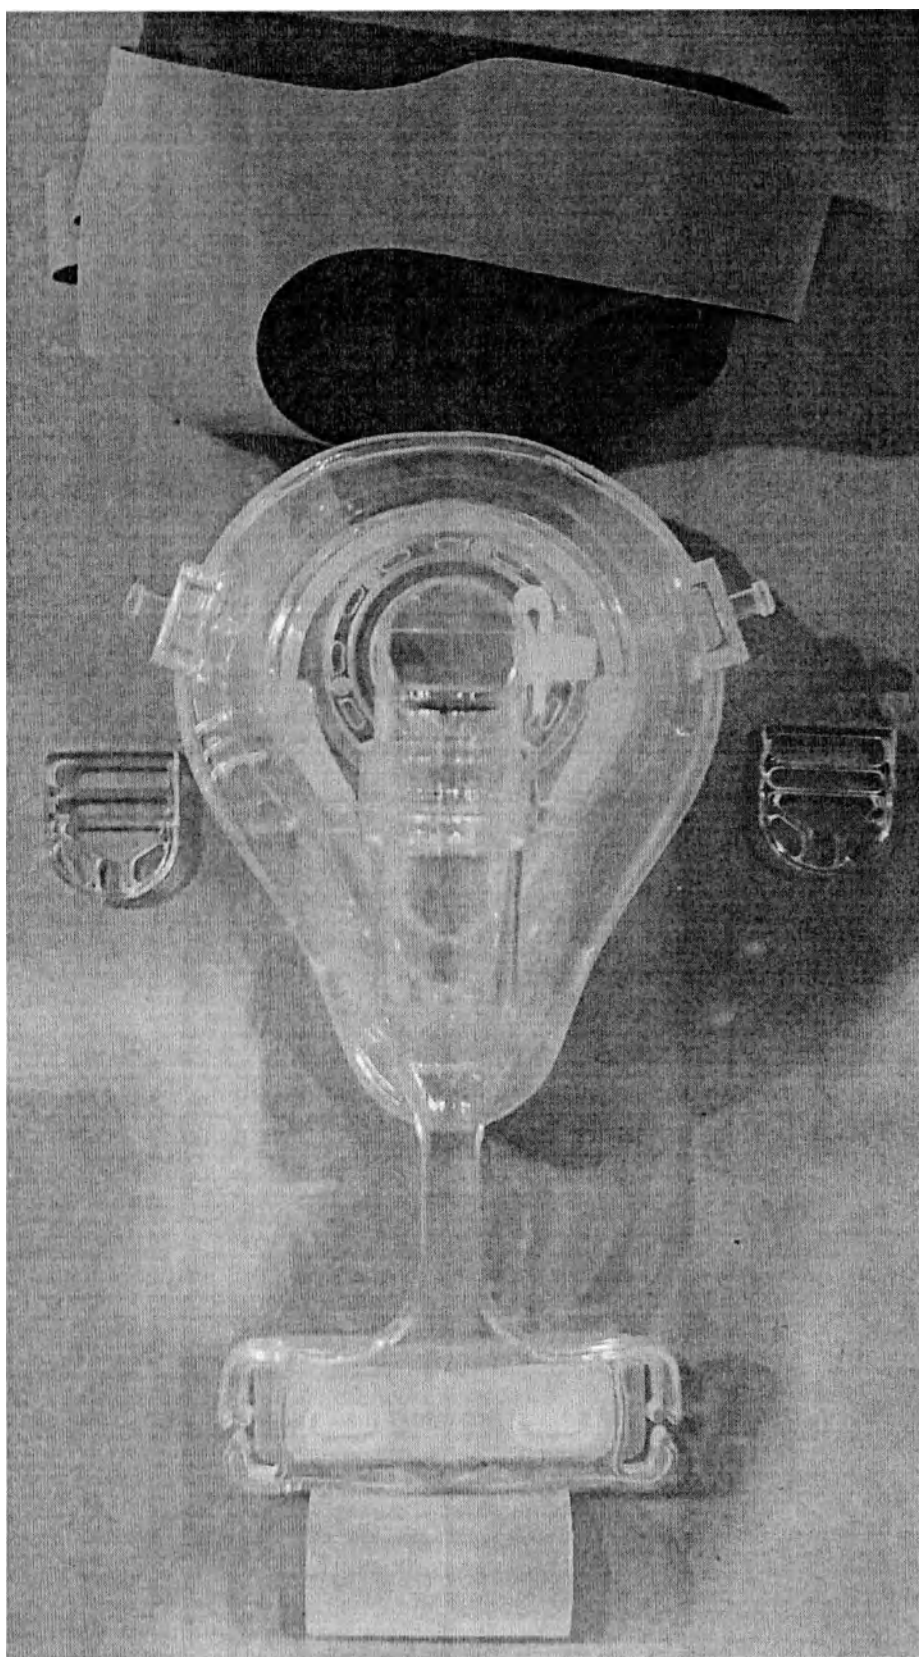


29 Маска NIV Full Face Respire: размер M, 641-009-NM, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

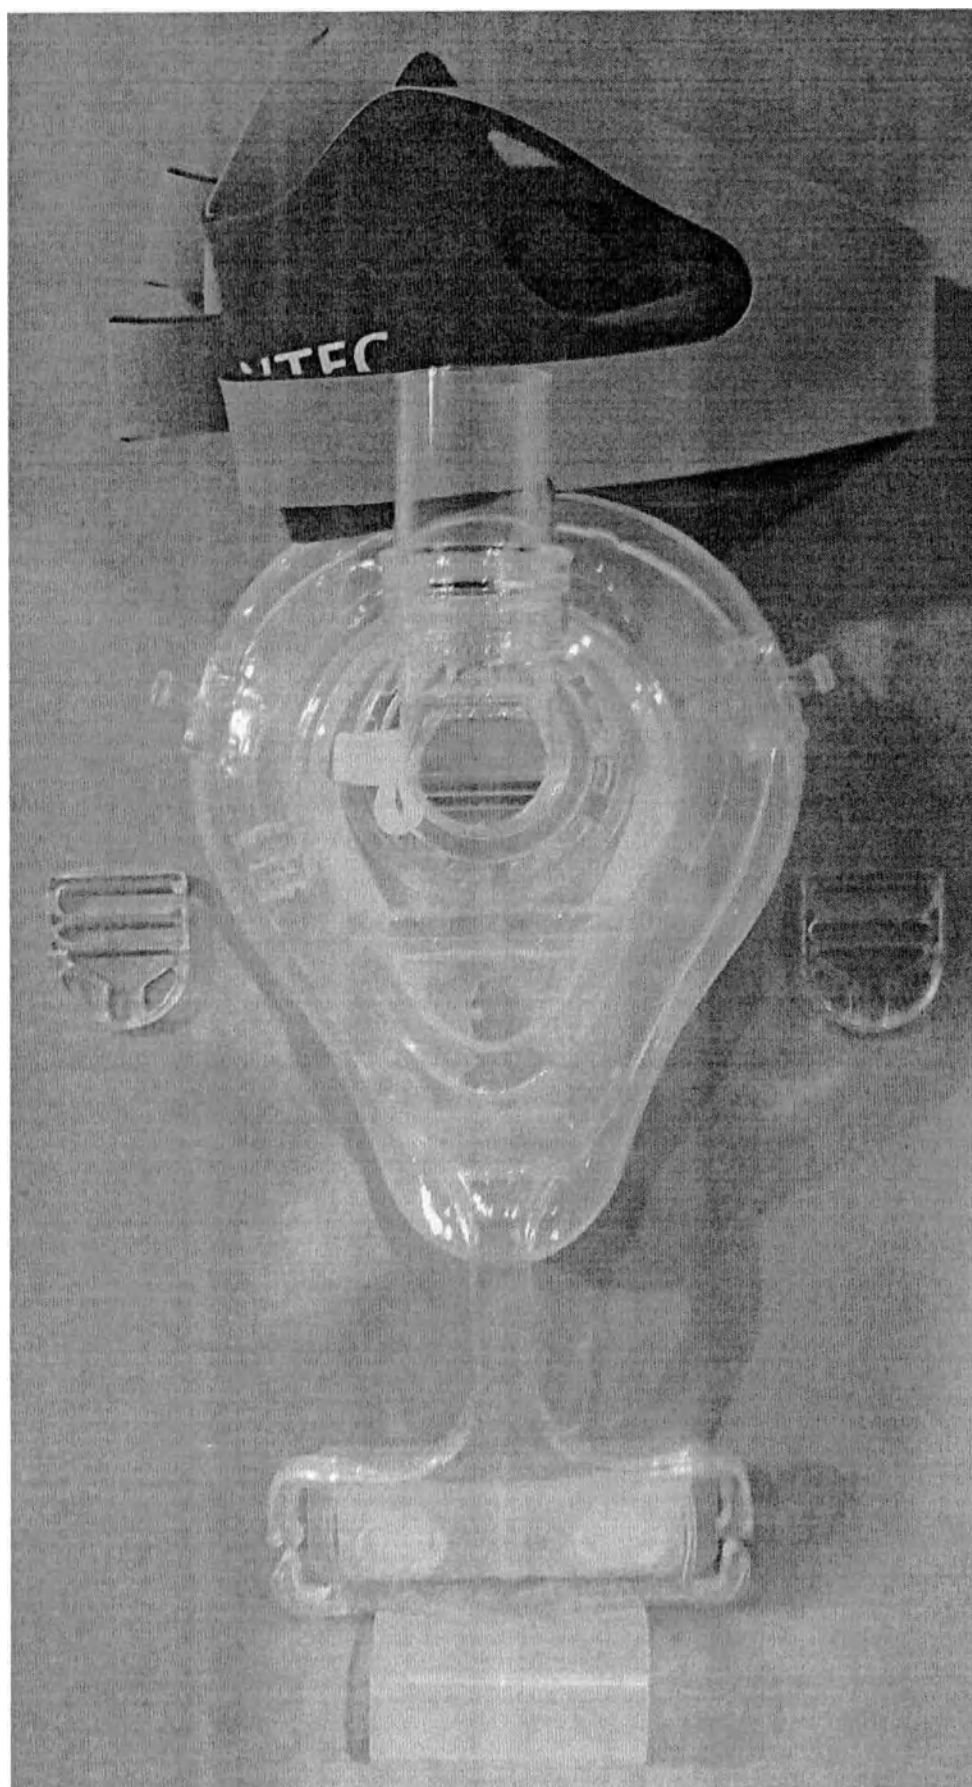

29 Маска NIV Full Face Respire: размер L, 641-009-NL, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

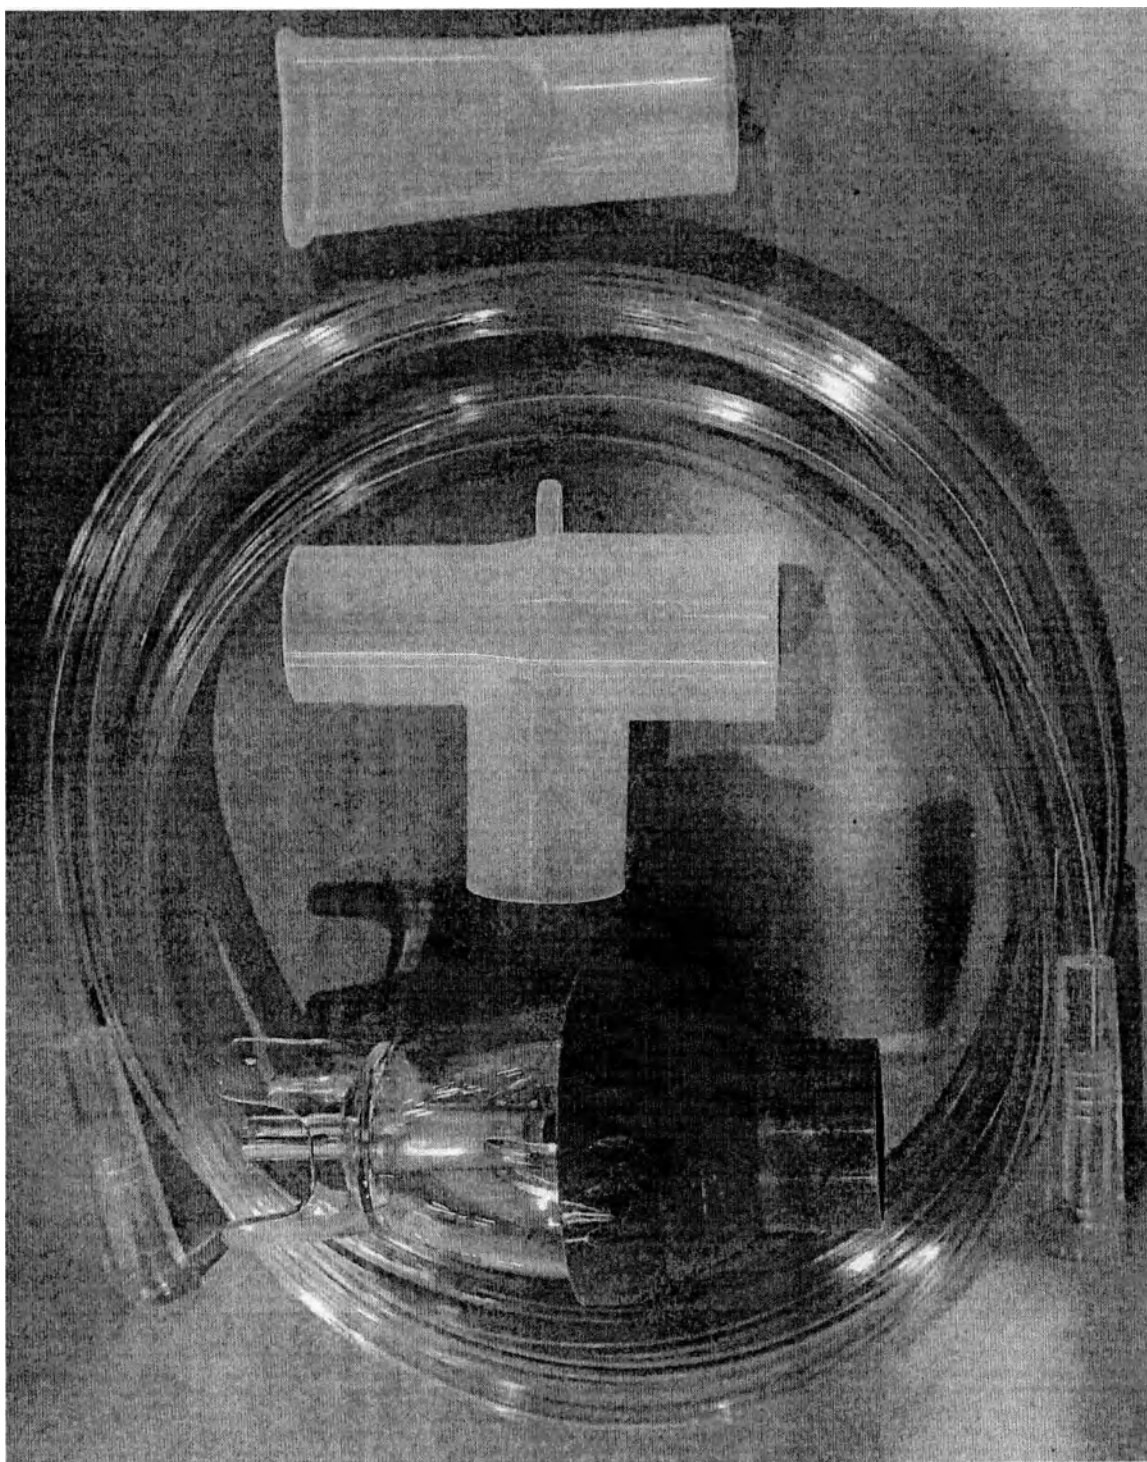


30 Распылитель, 032-10-005, Flexicare Medical Limited, Великобритания

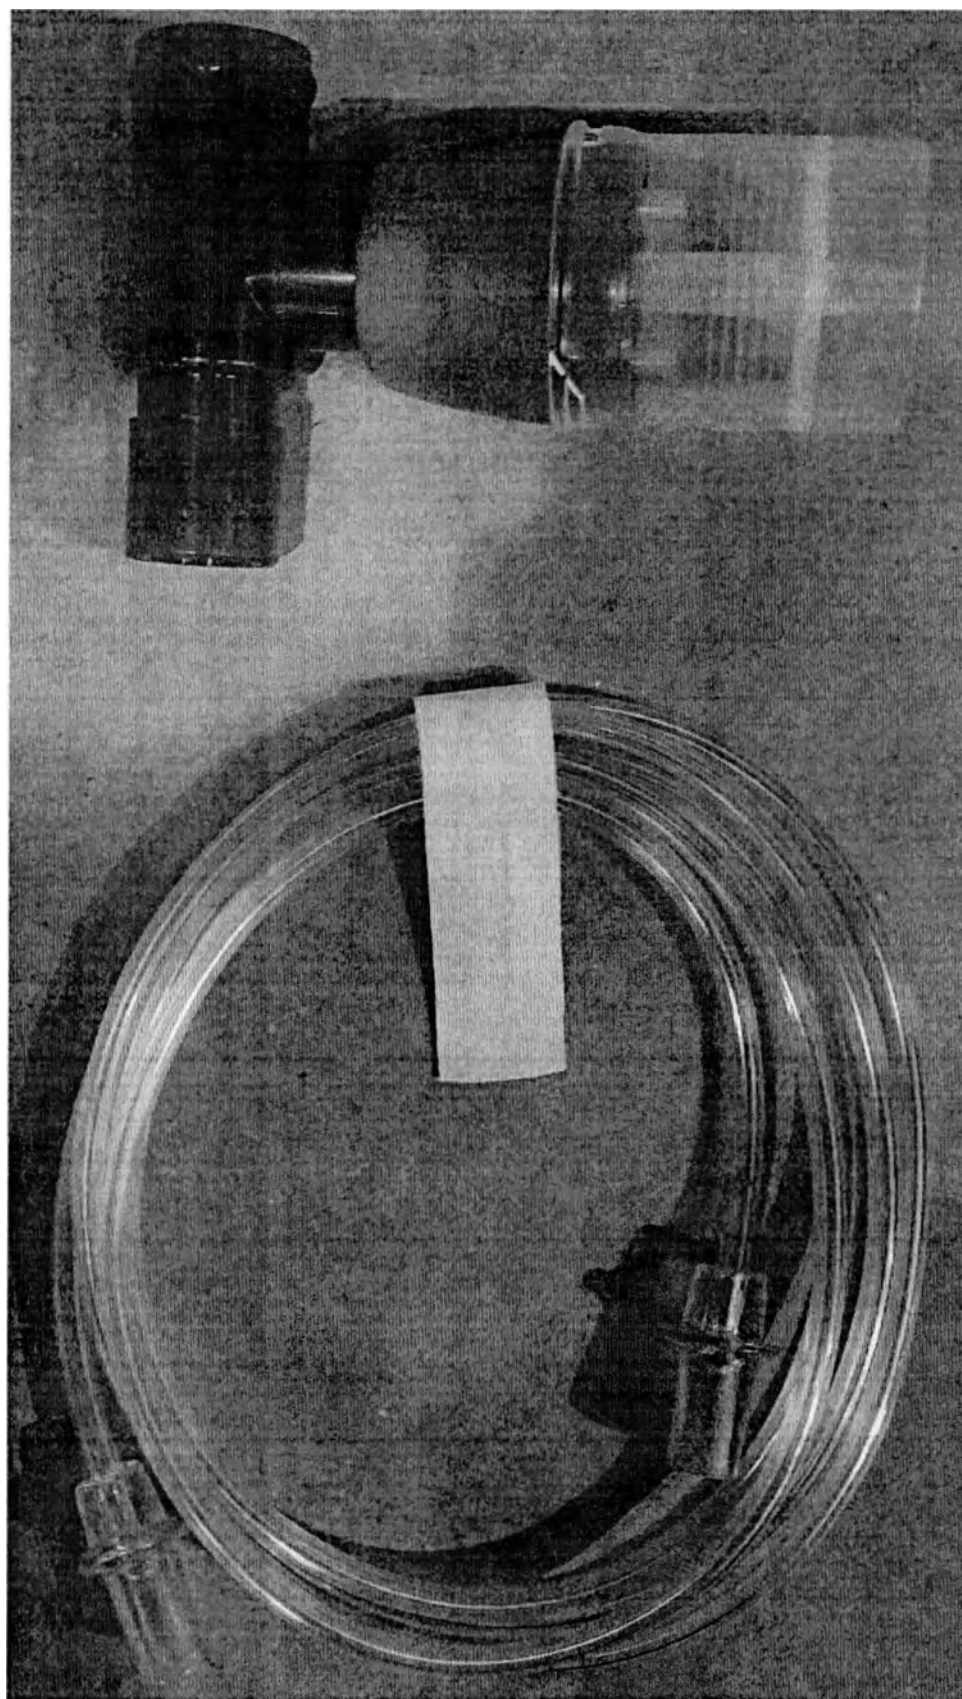


**30 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии:
распылитель в комплекте: с коннектором и трубкой, 2605000, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания
(Intersurgical Ltd)**




31 Небулайзер микропомповый, в составе: - генератор тип А; - генератор тип В; - блок управления с таймером; - USB адаптер, GUN-300vt, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

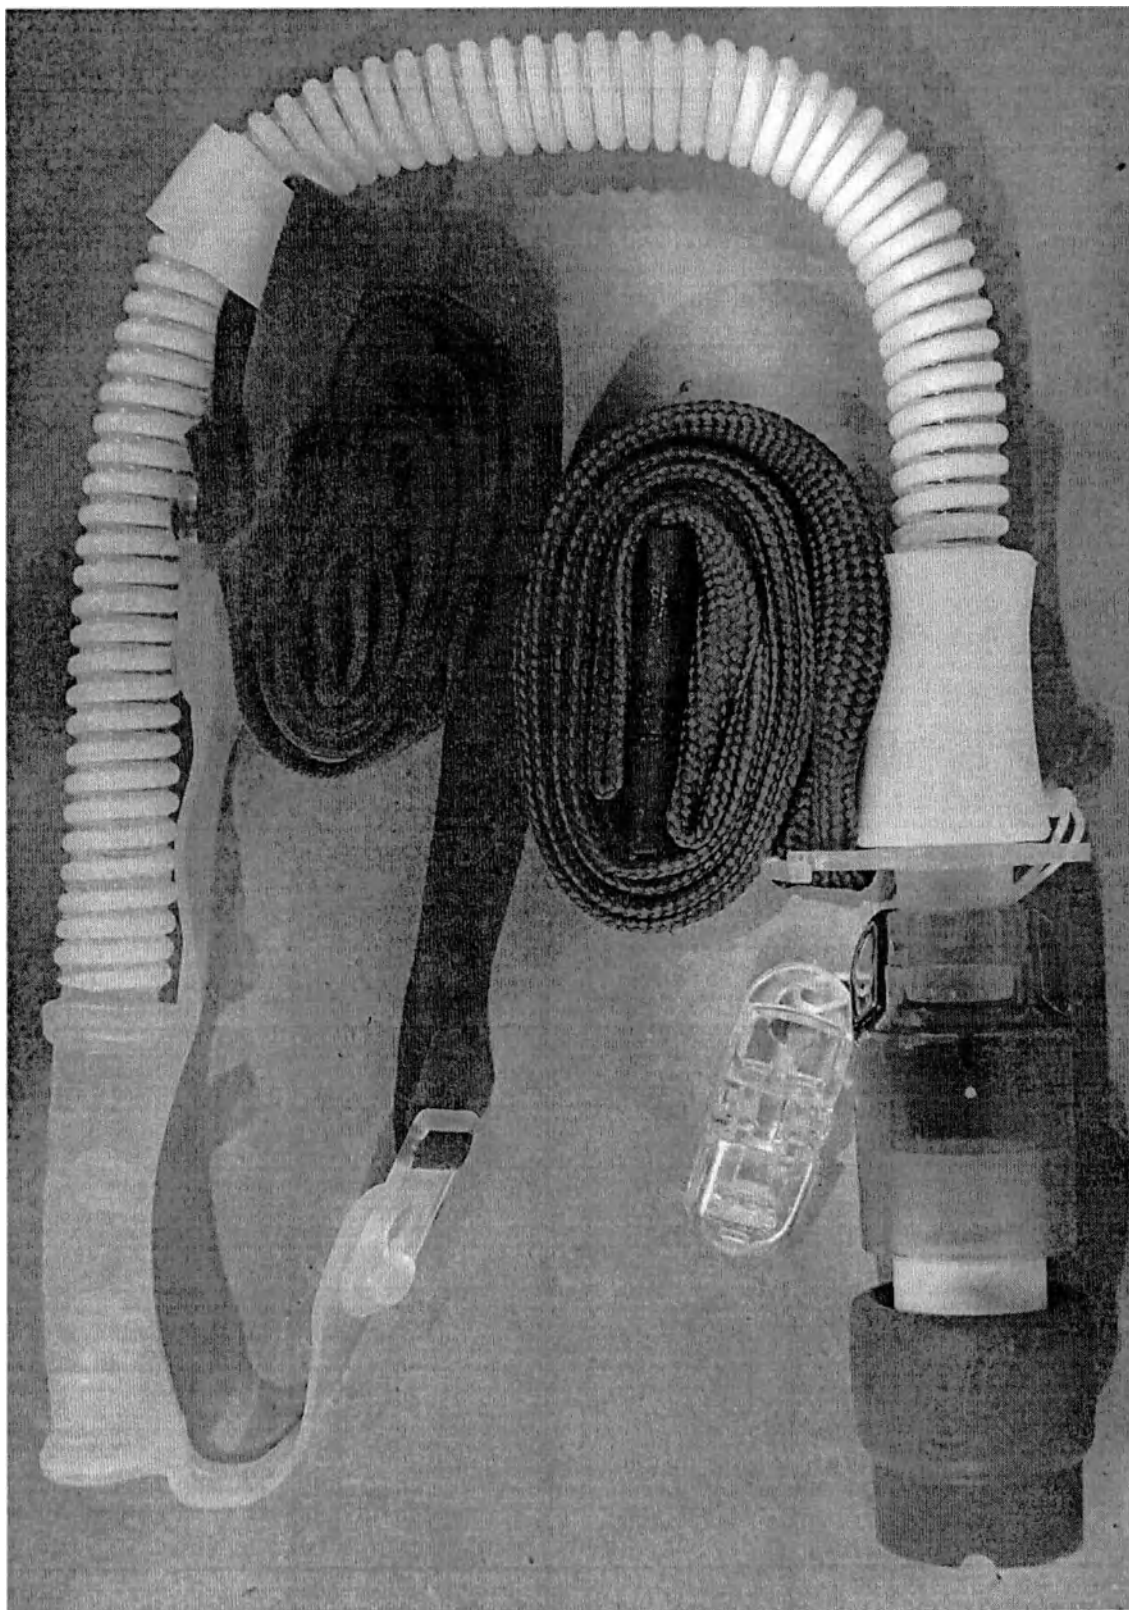


32 Канюля высокопоточная назальная для взрослых Veoflo®: размер S, 032-10-170, Flexicare Medical Limited, Великобритания

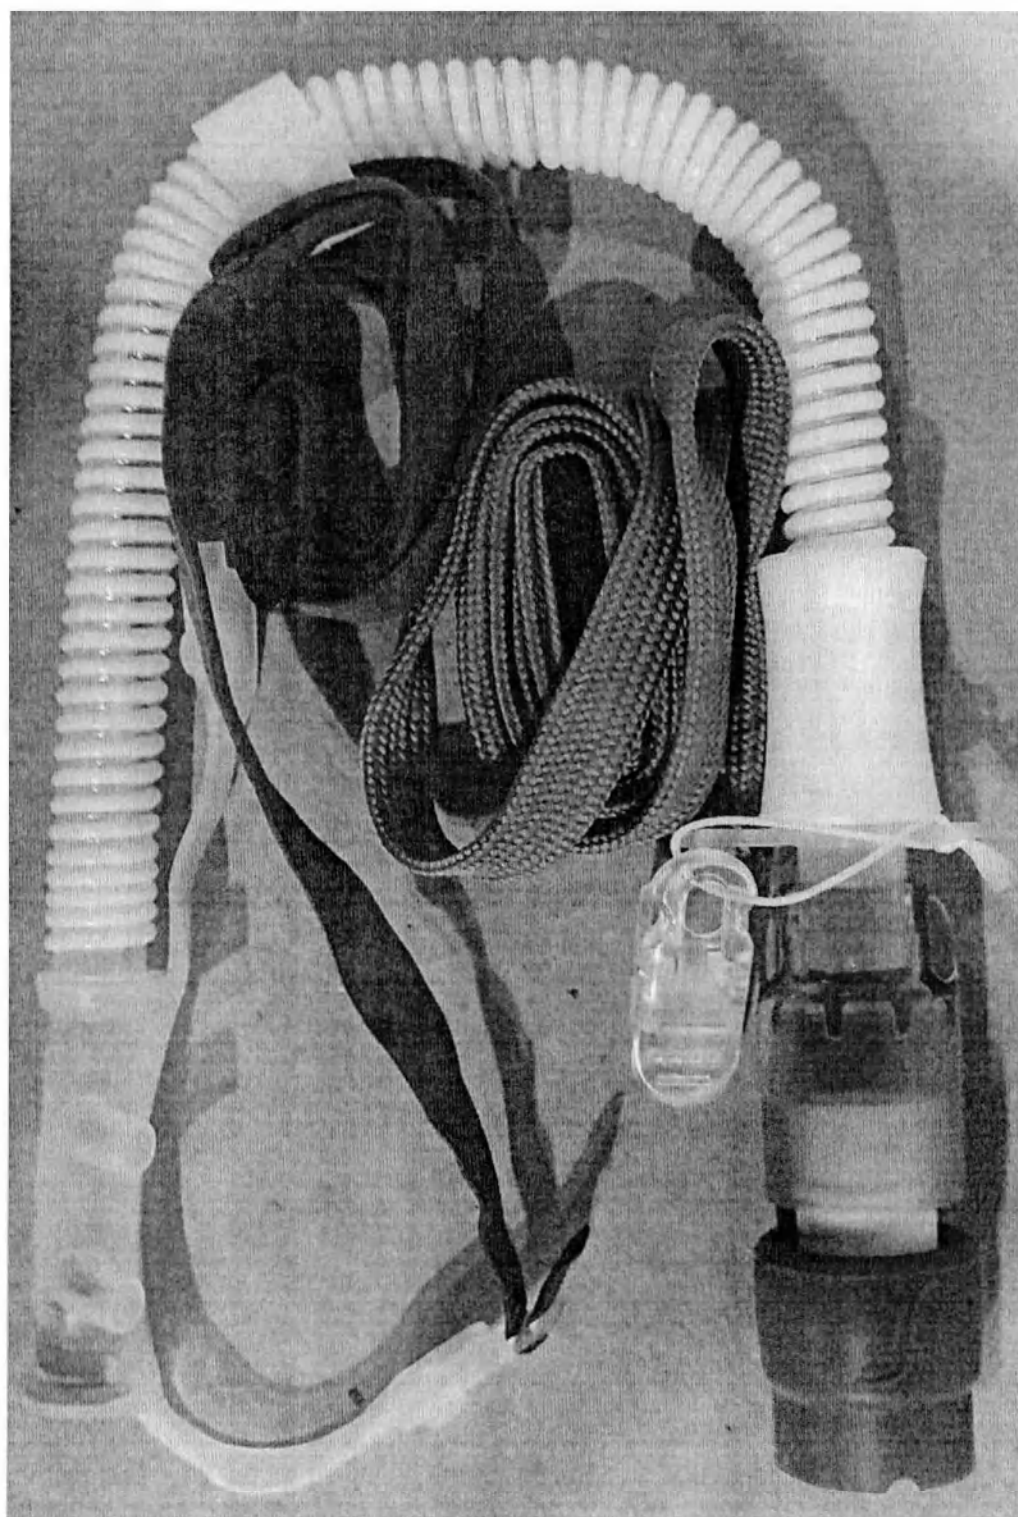


32 Канюля высокопоточная назальная для взрослых Veoflo®: размер М, 032-10-171, Flexicare Medical Limited, Великобритания

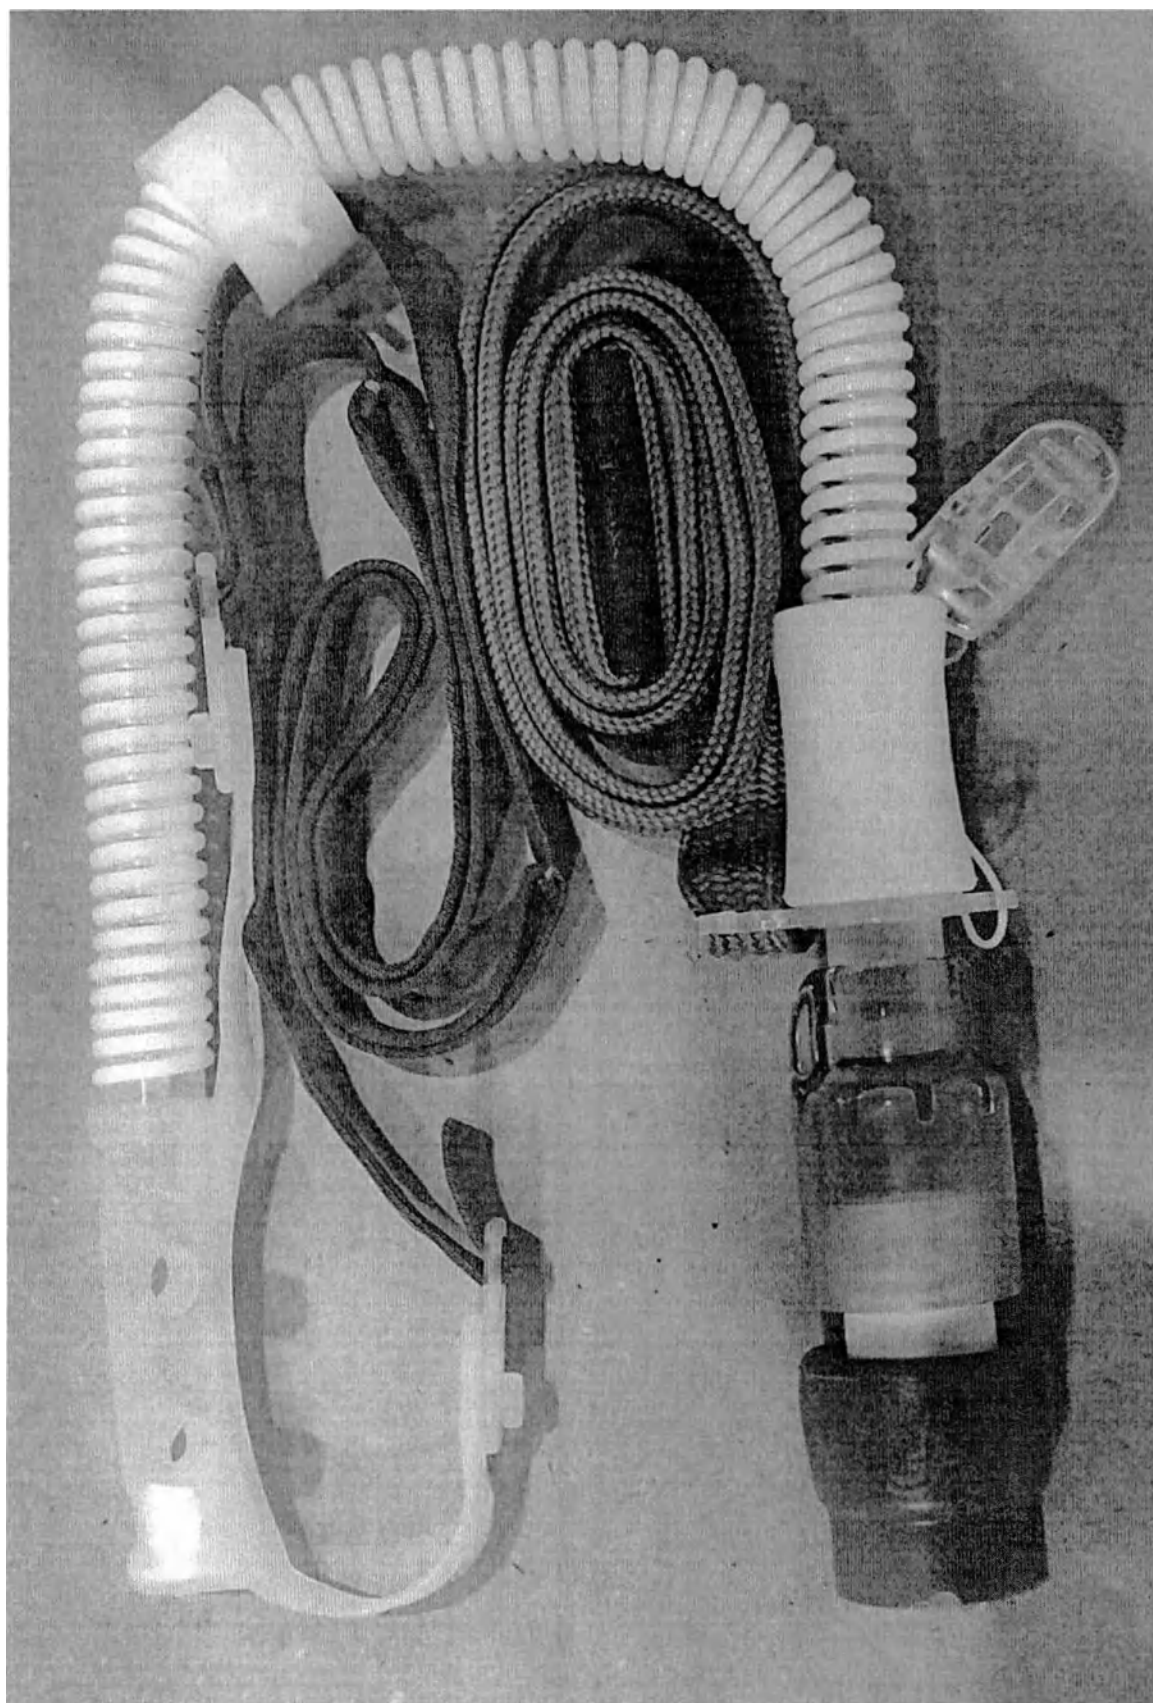


32 Канюля высокопоточная назальная для взрослых Veoflo®: размер L, 032-10-172, Flexicare Medical Limited, Великобритания

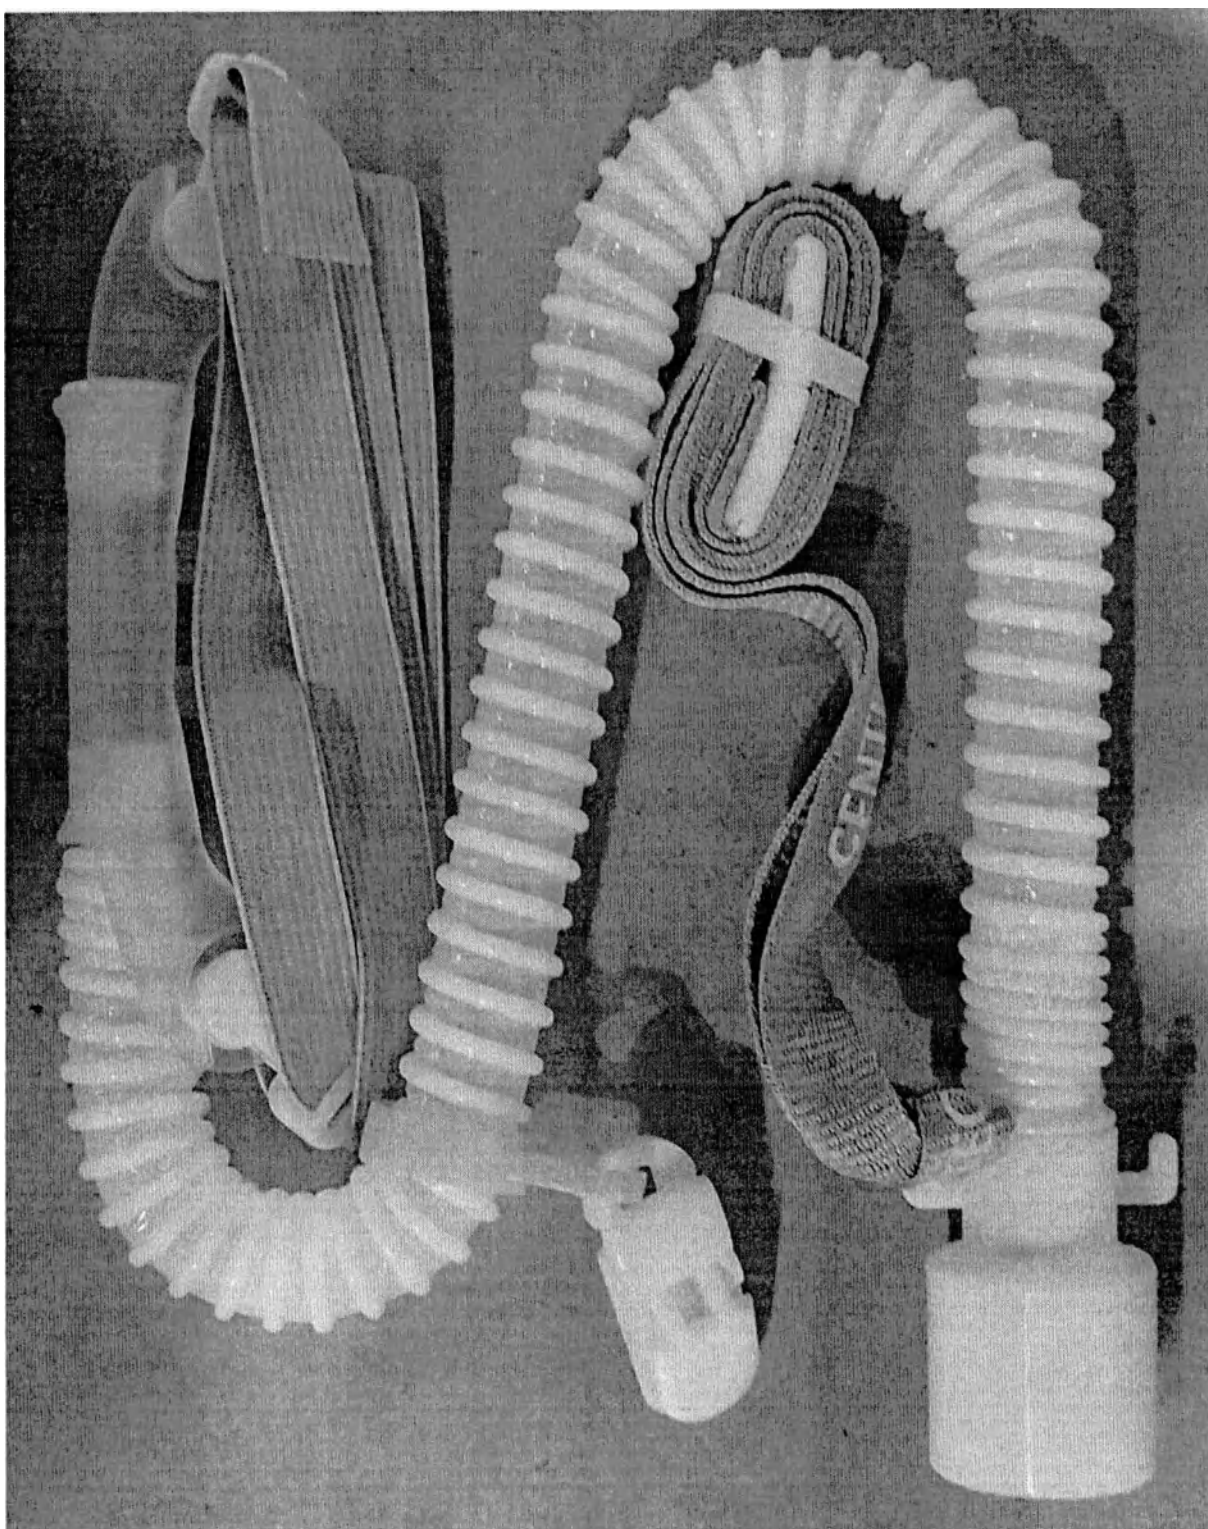


32 Канюли назальные взрослые High Flow: размер S, 681-103, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

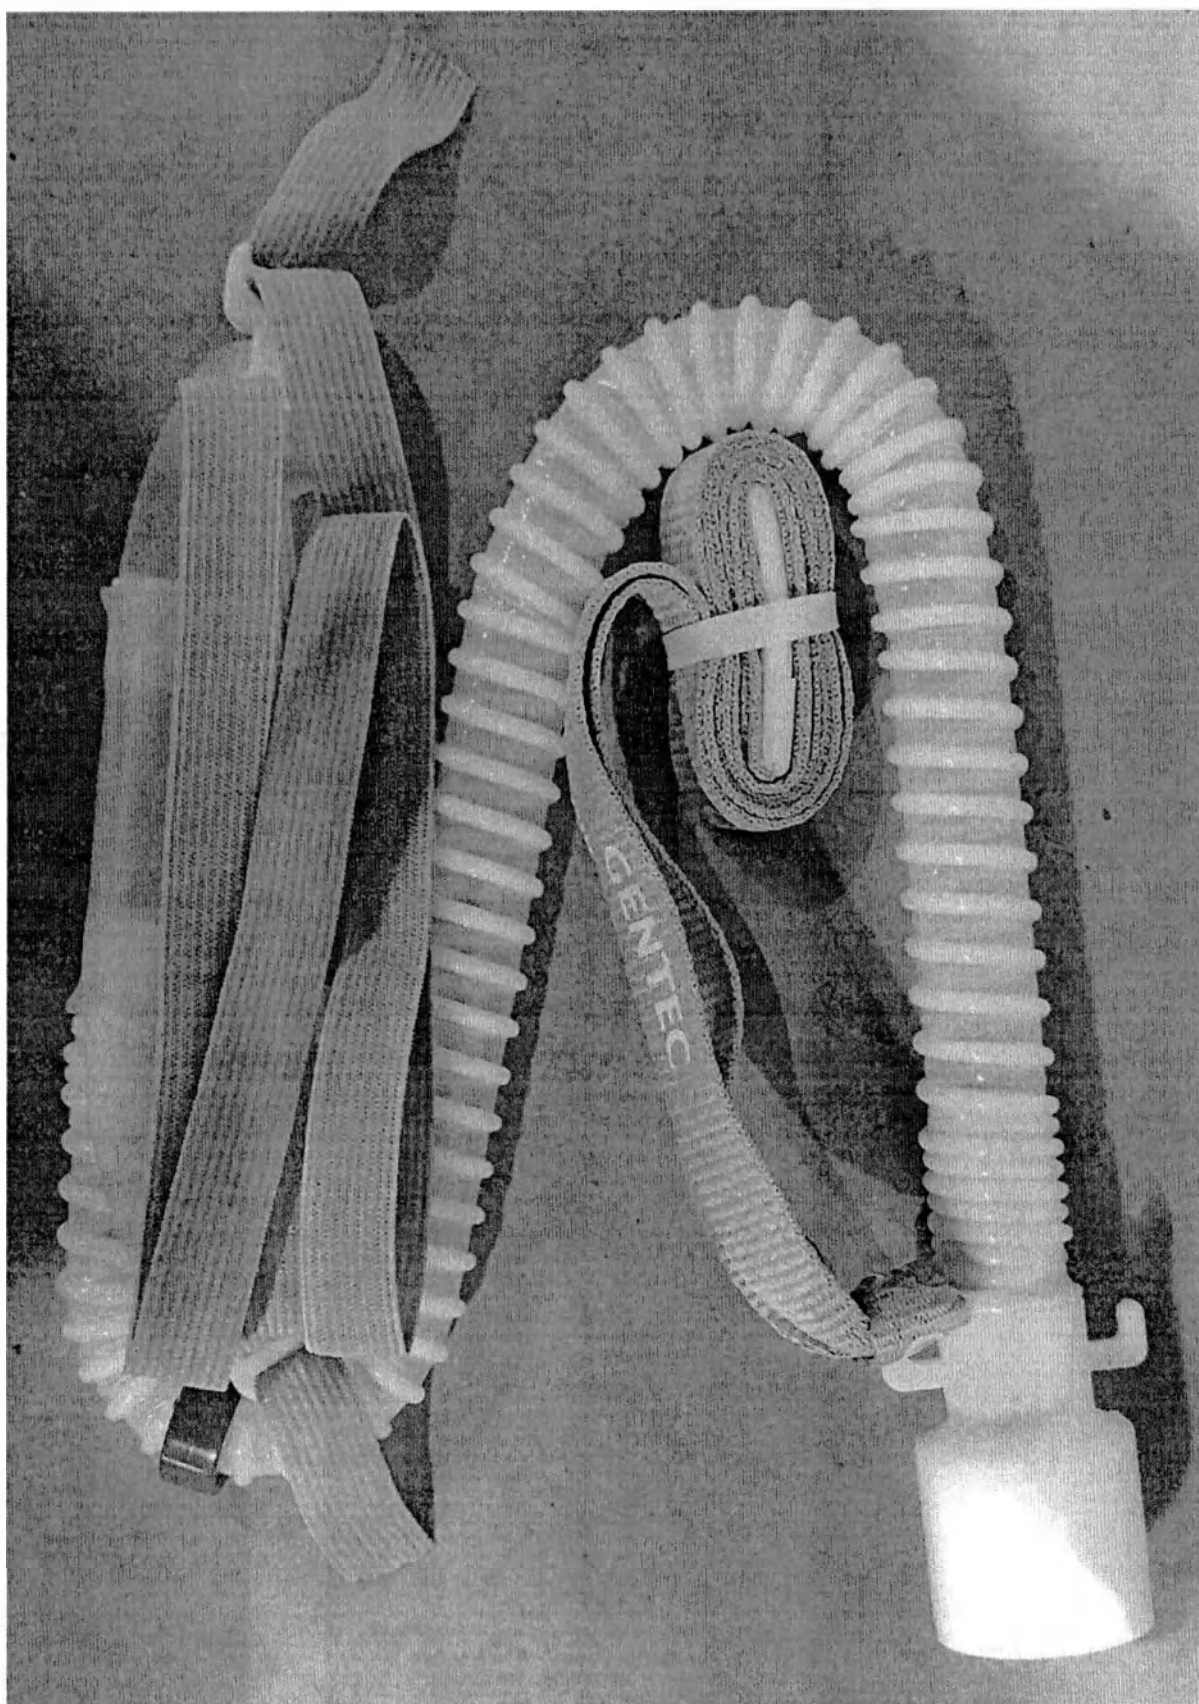


32 Канюли назальные взрослые High Flow: размер M, 681-102, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

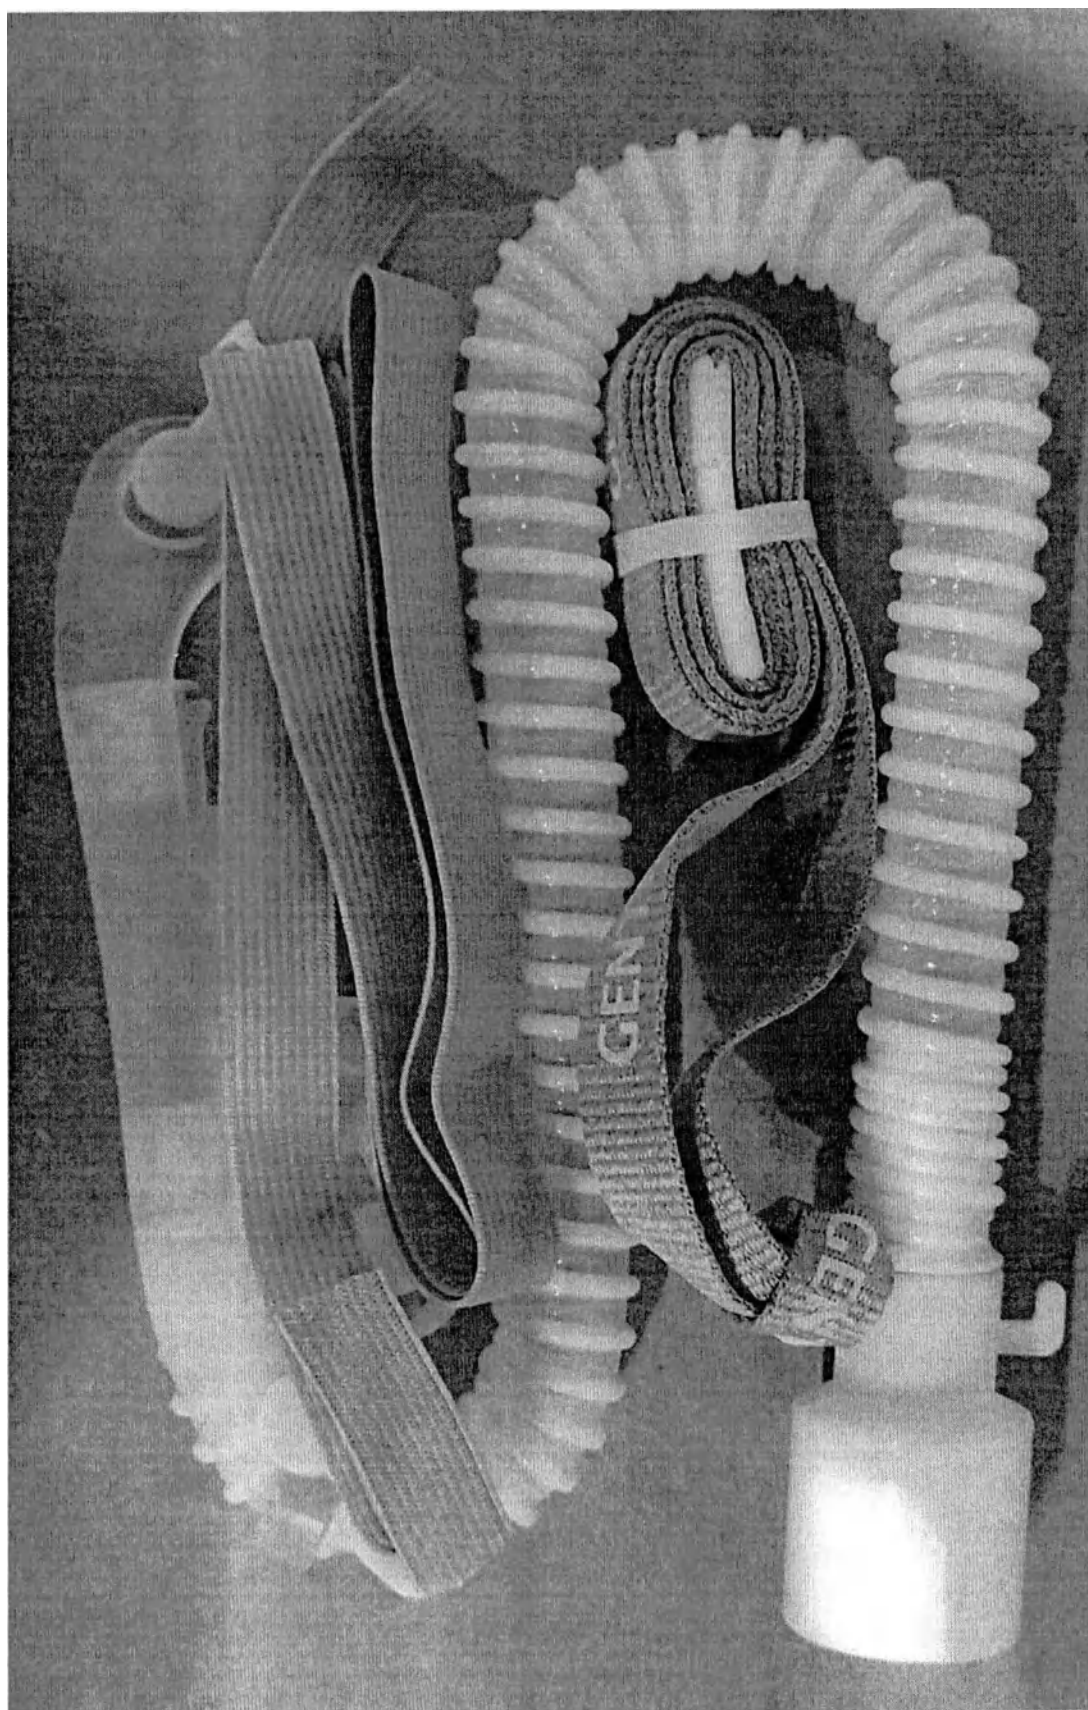


32 Канюли назальные взрослые High Flow: размер L, 681-101, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

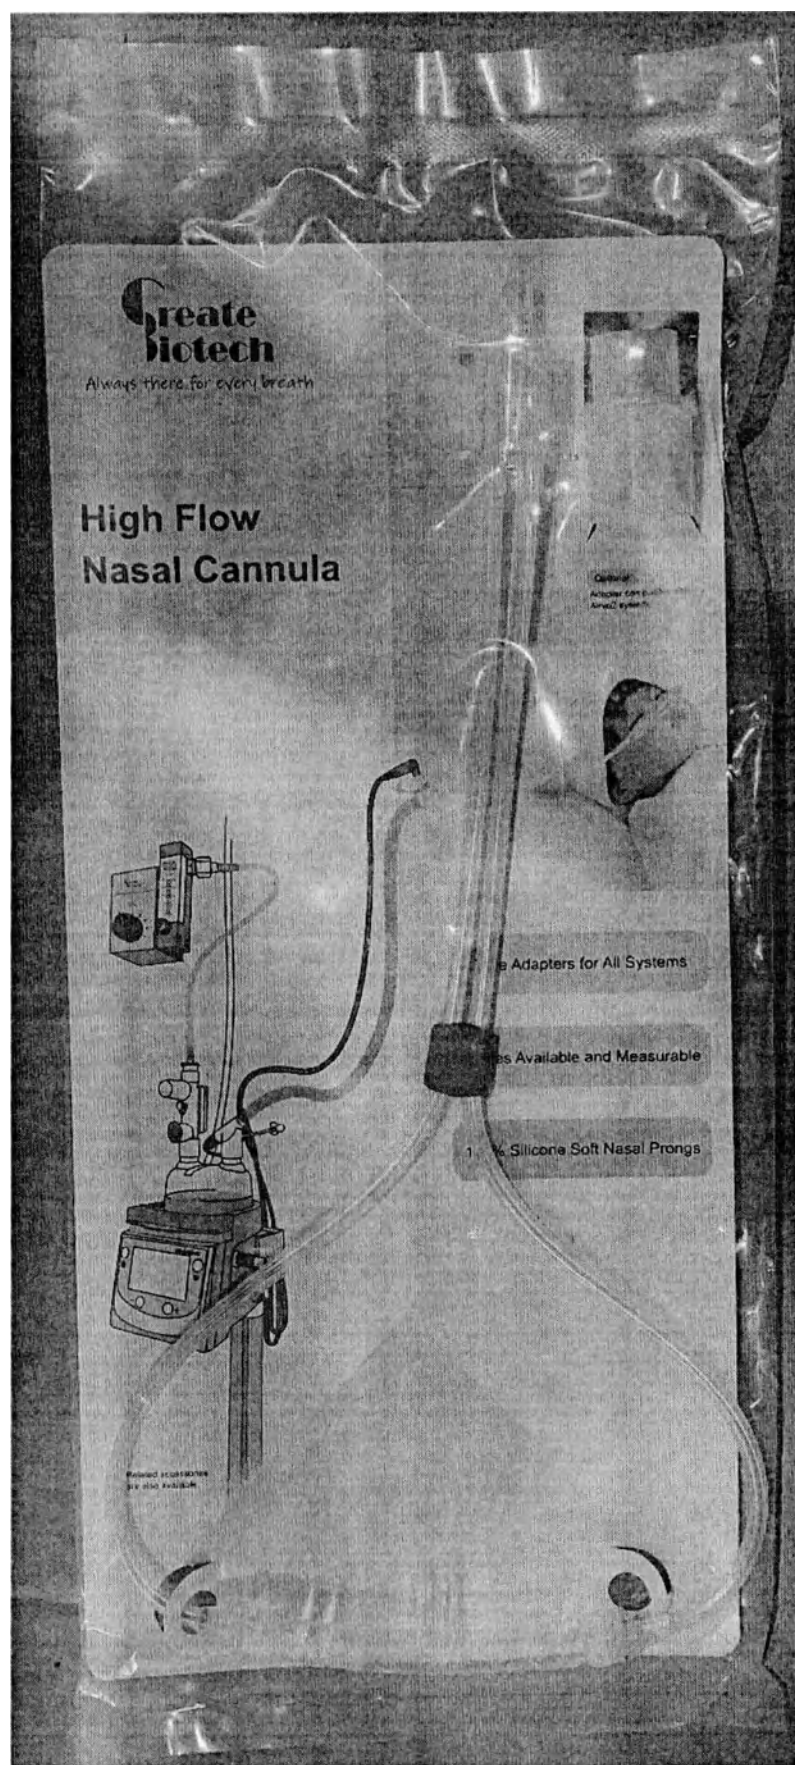


33 Канюля назальная высокопоточная для новорожденных High flow nasal cannula: размер 2, 016-014-102, Create Biotech Co., Ltd, Тайвань

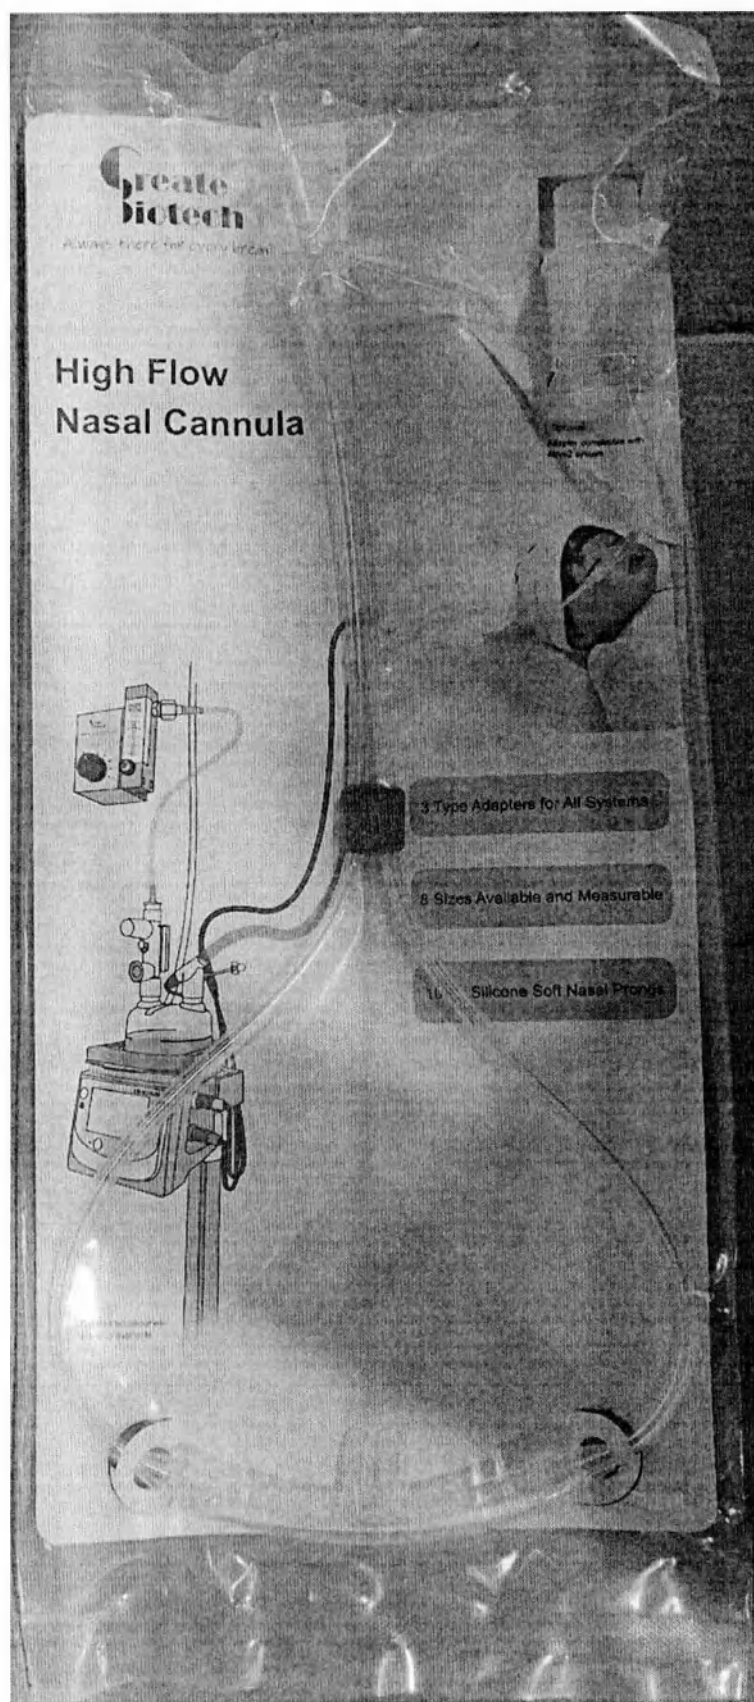


33 Канюля назальная высокопоточная для новорожденных High flow nasal cannula: размер 4, 016-014-104, Create Biotech Co., Ltd, Тайвань

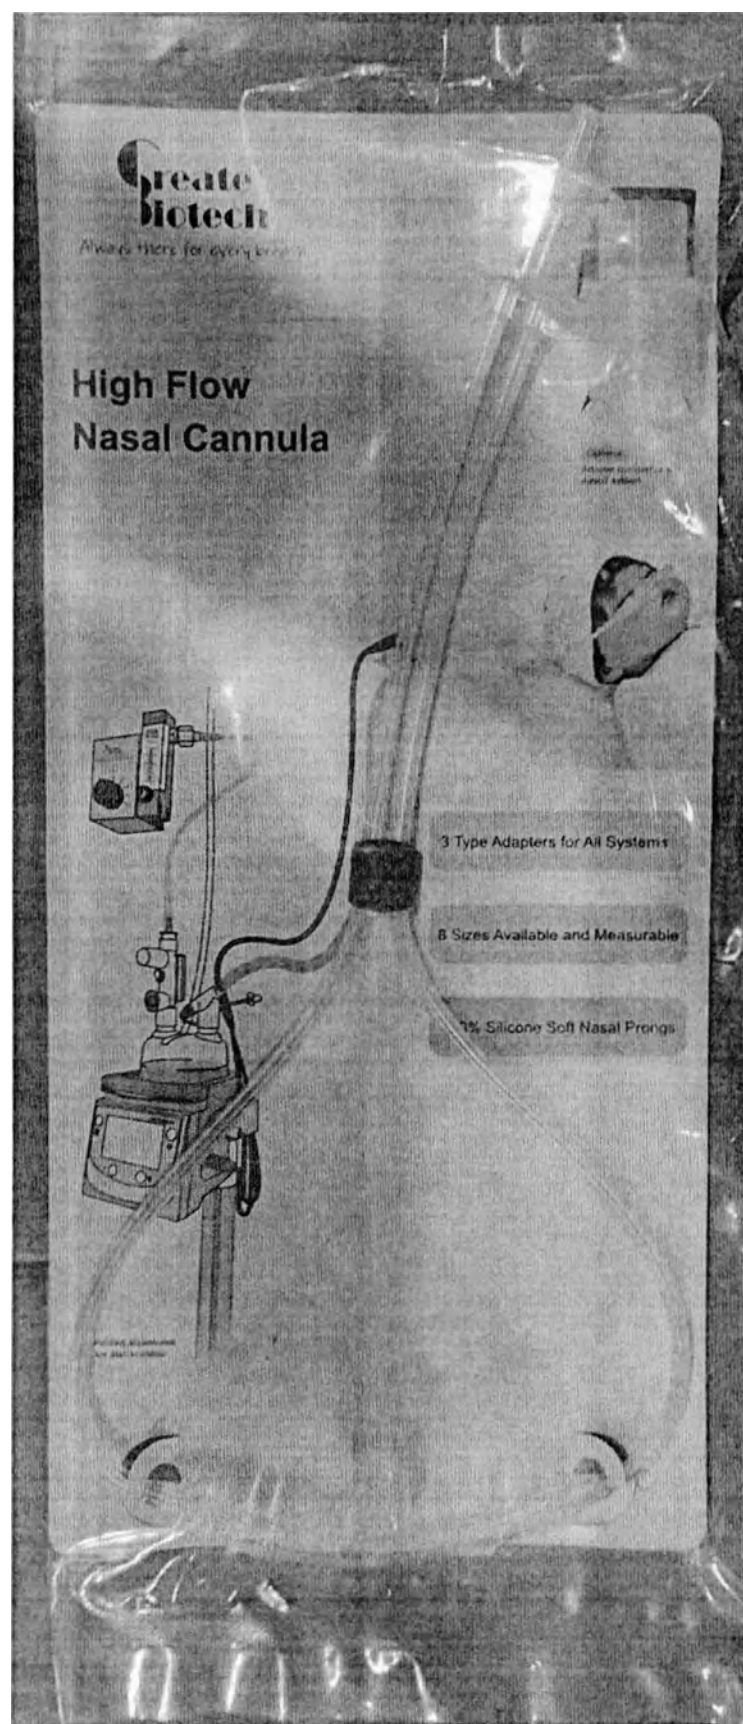


33 Канюля назальная высокопоточная для новорожденных High flow nasal cannula: размер 6, 016-014-106, Create Biotech Co., Ltd, Тайвань

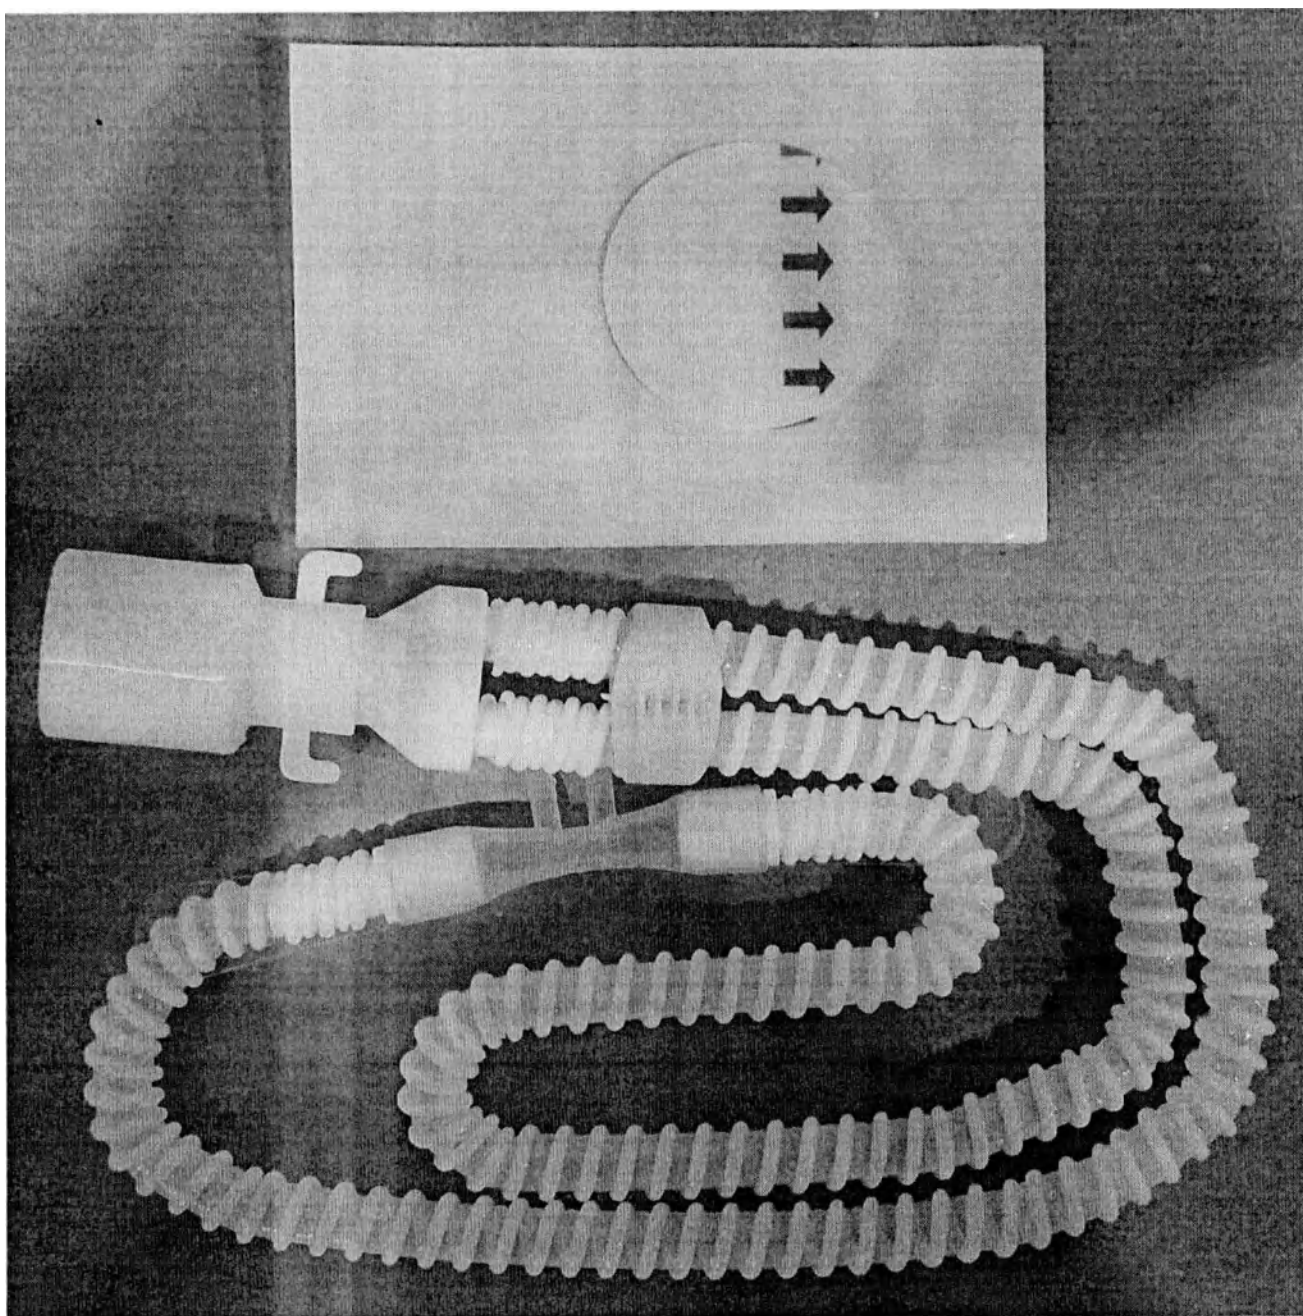


33 Канюли назальные неонатальные High Flow: размер S, 681-203, Gentec (Shanghai) Corporation, КНР

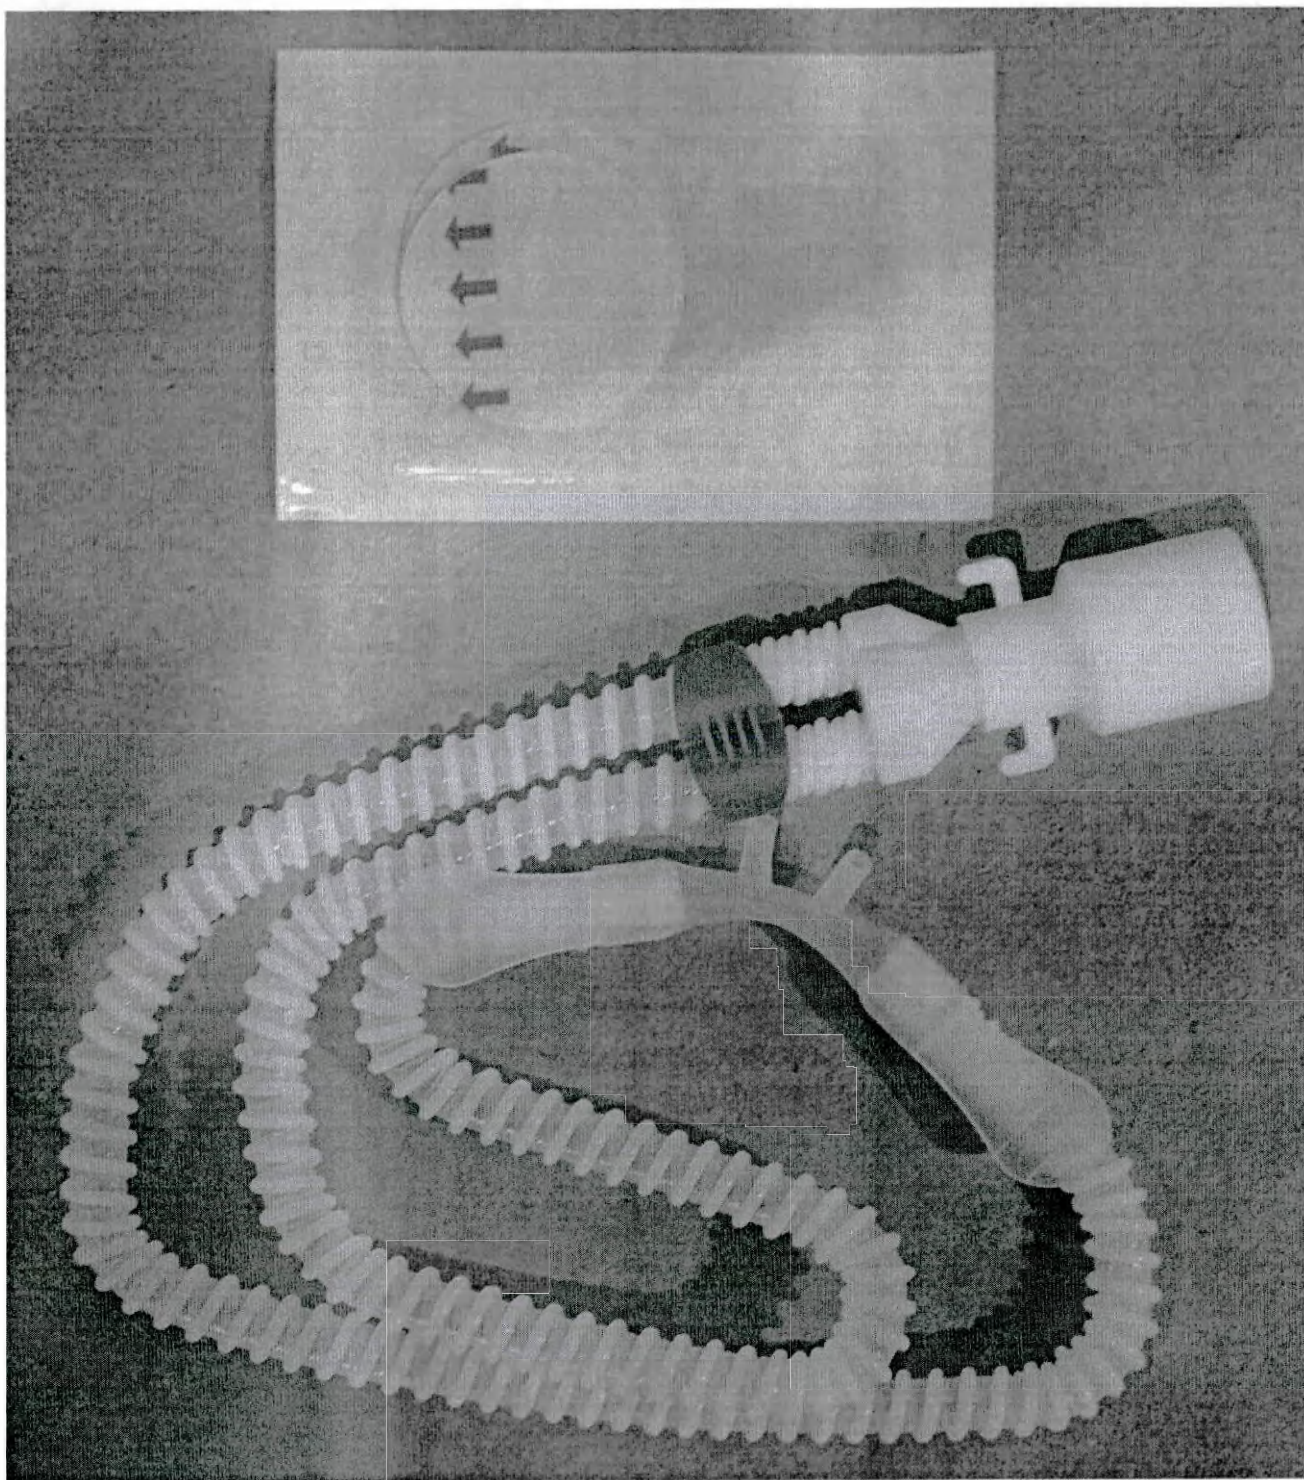


33 Канюли назальные неонатальные High Flow: размер M, 681-202, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

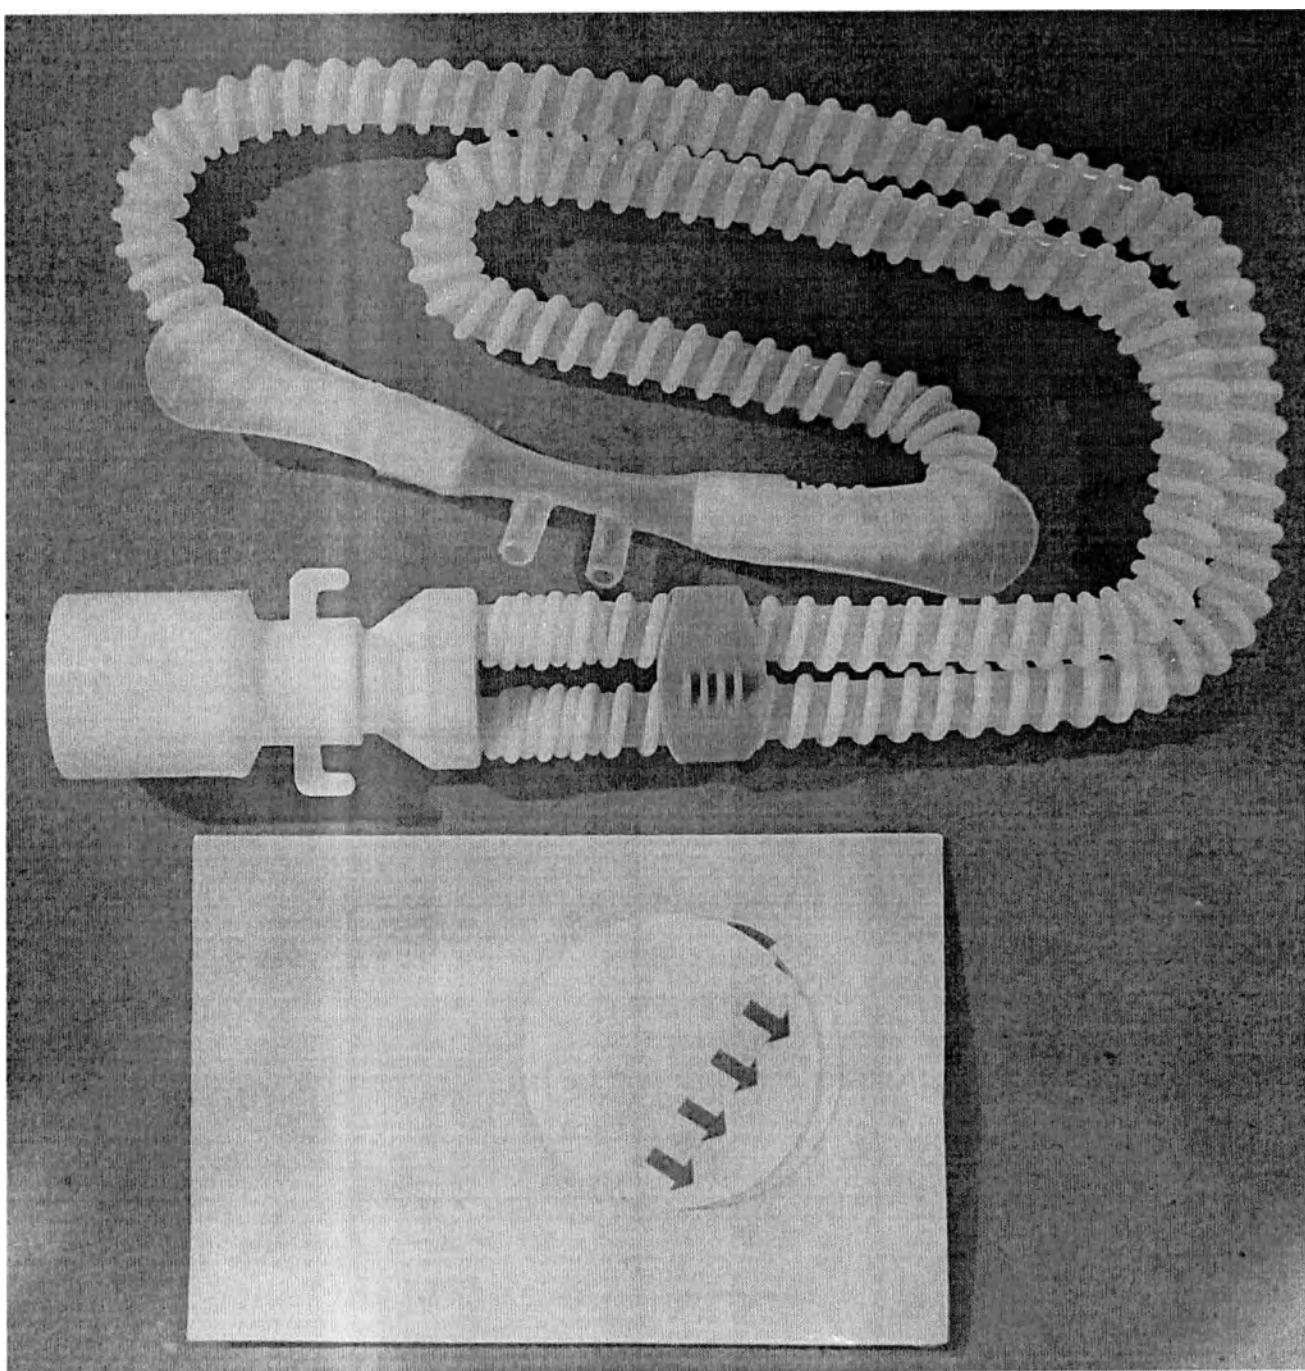


33 Канюли назальные неонатальные High Flow: размер L, 681-201, Gentec (Shanghai) Corporation, KHP

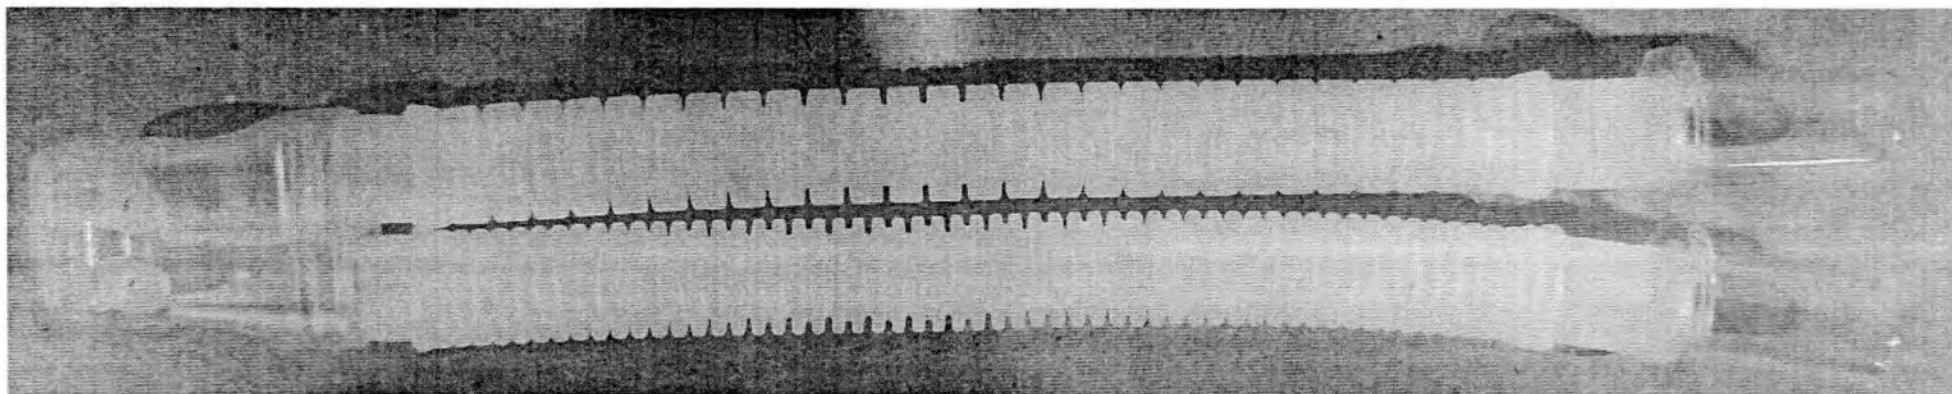


34 Генератор nCPAP Miniflow® одноразовый, 4000, medin Medical Innovations GmbH, Германия

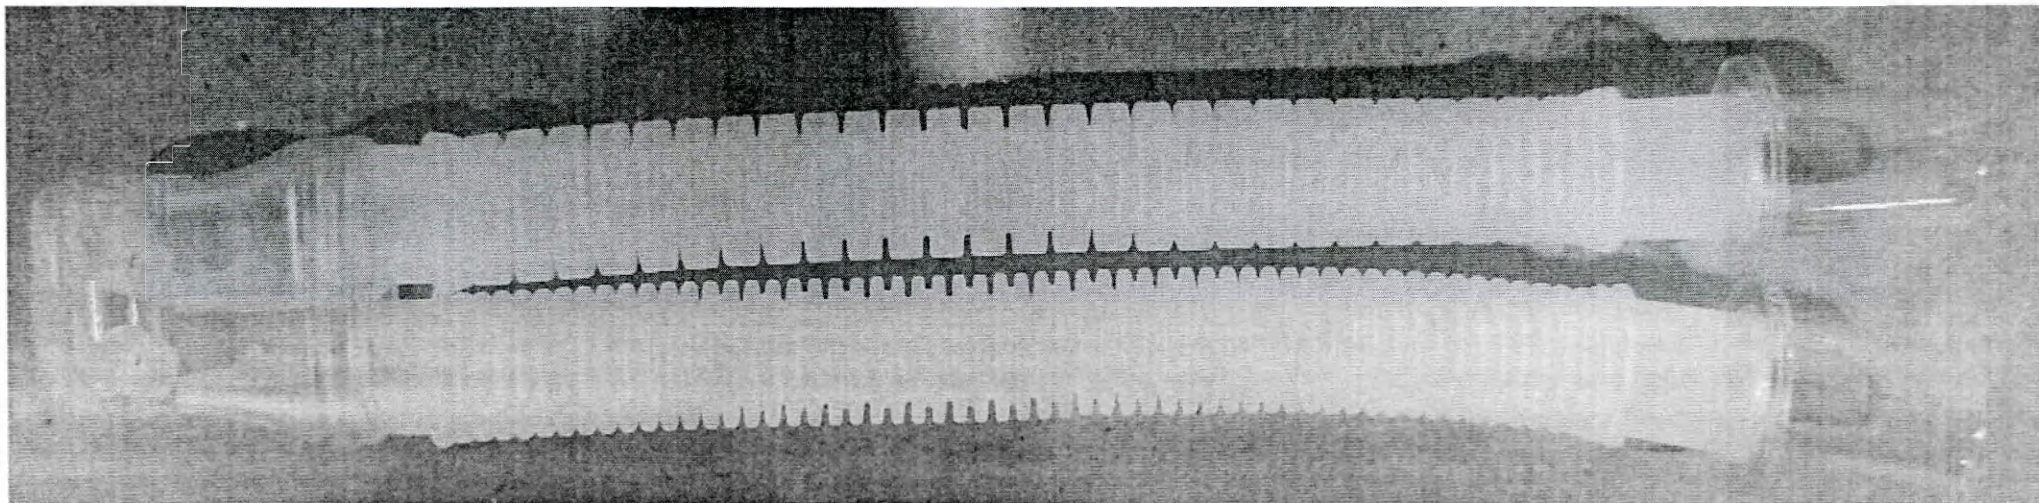


35.1 Генератор nCPAP Miniflow® одноразовый, 4000, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

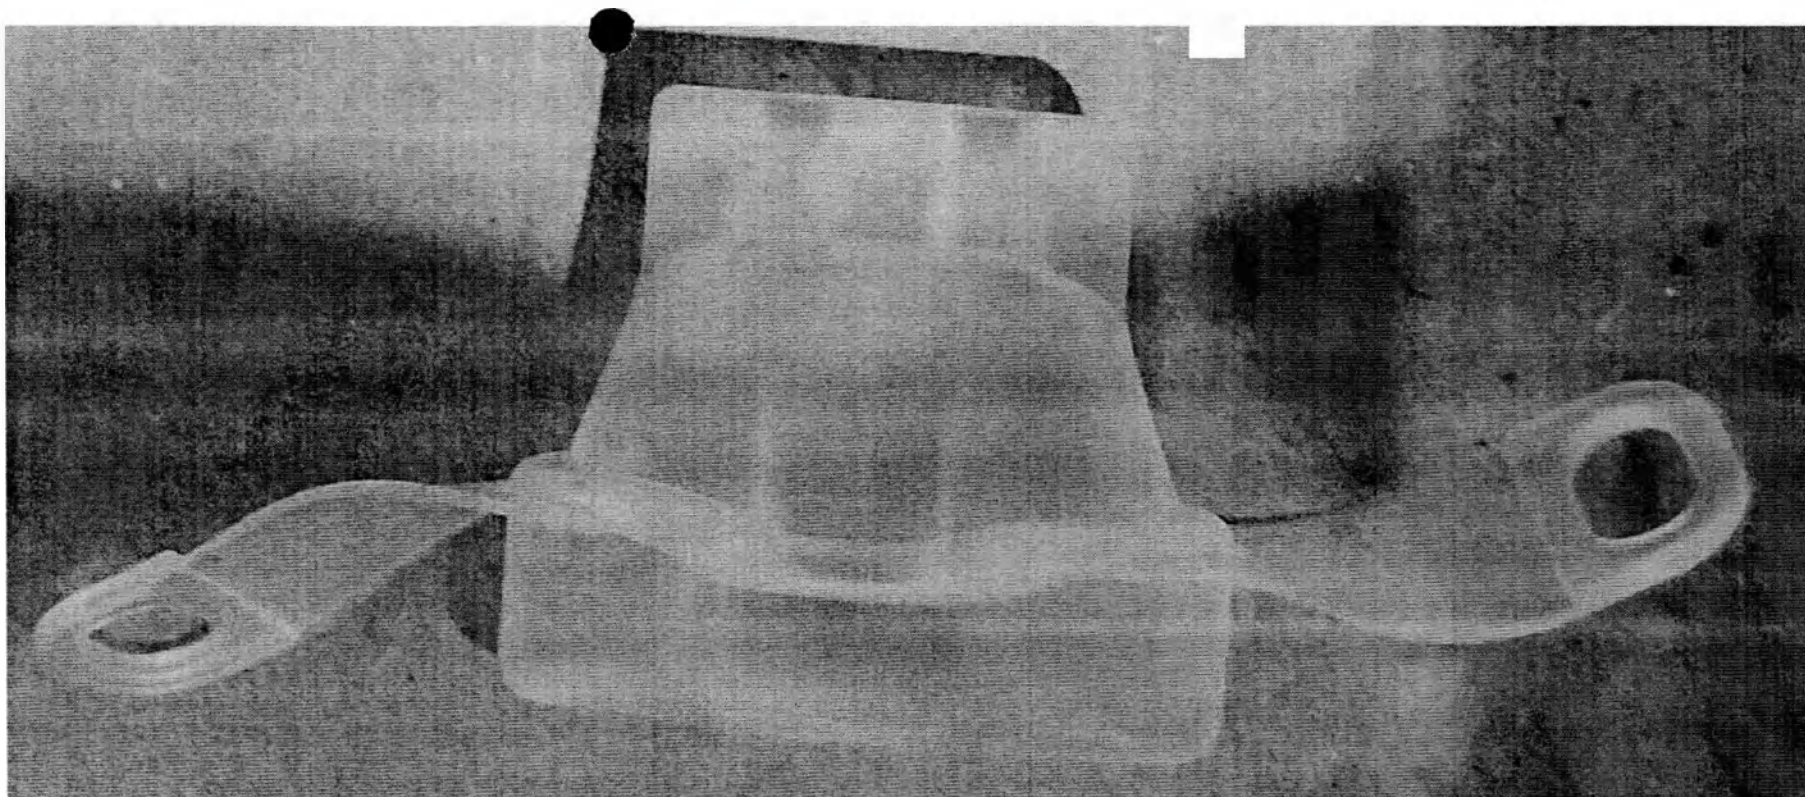


35.2 Маски одноразовые, размер S, 1200-04, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

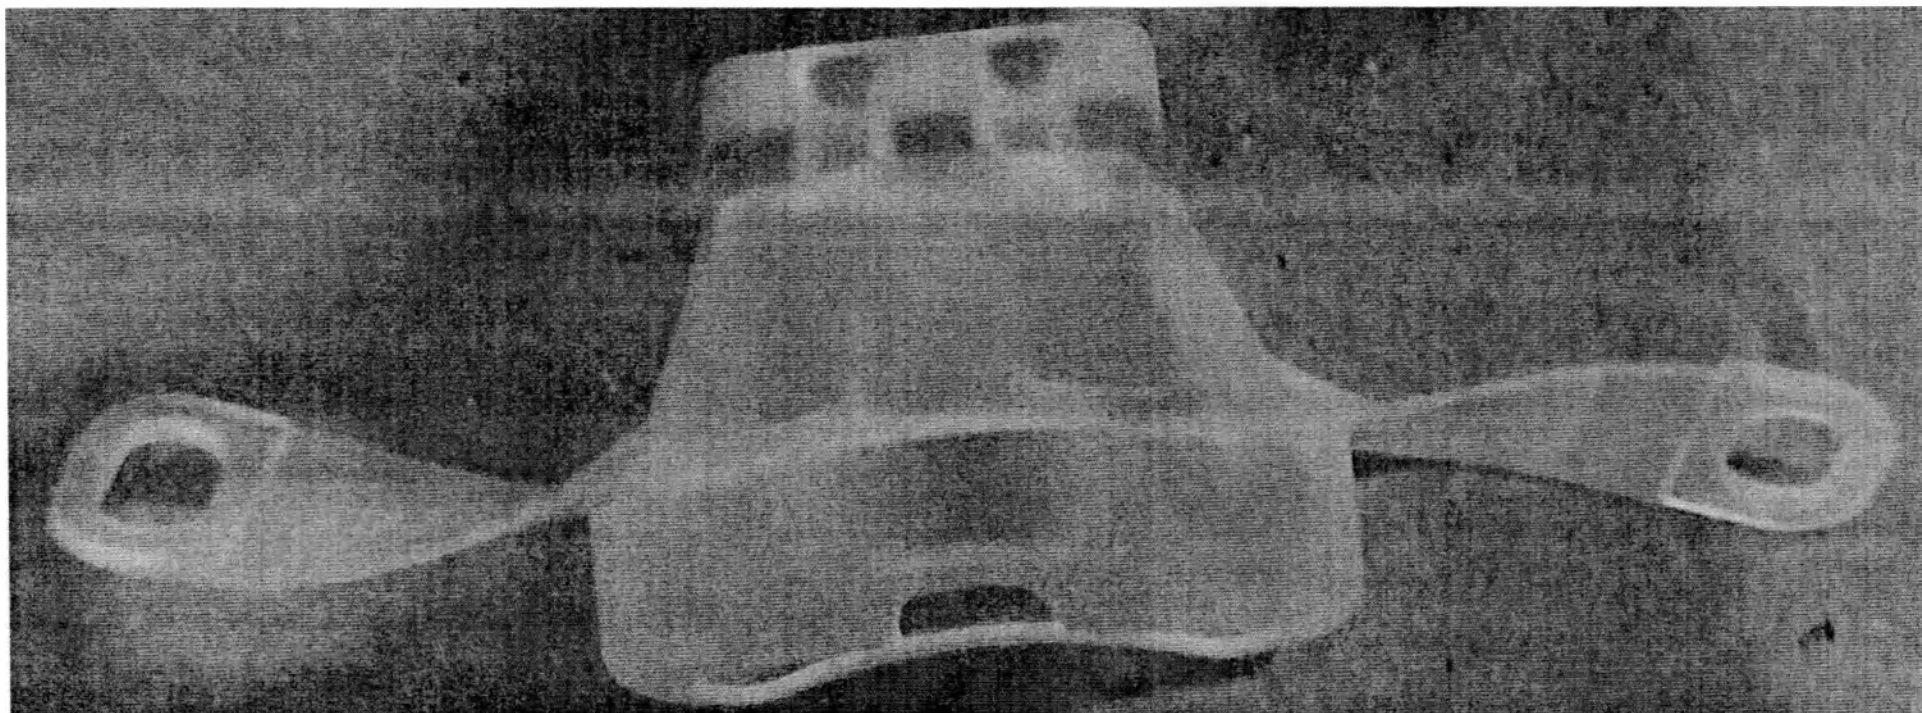


35.2 Маски одноразовые, размер М, 1200-05, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для пИМВ, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

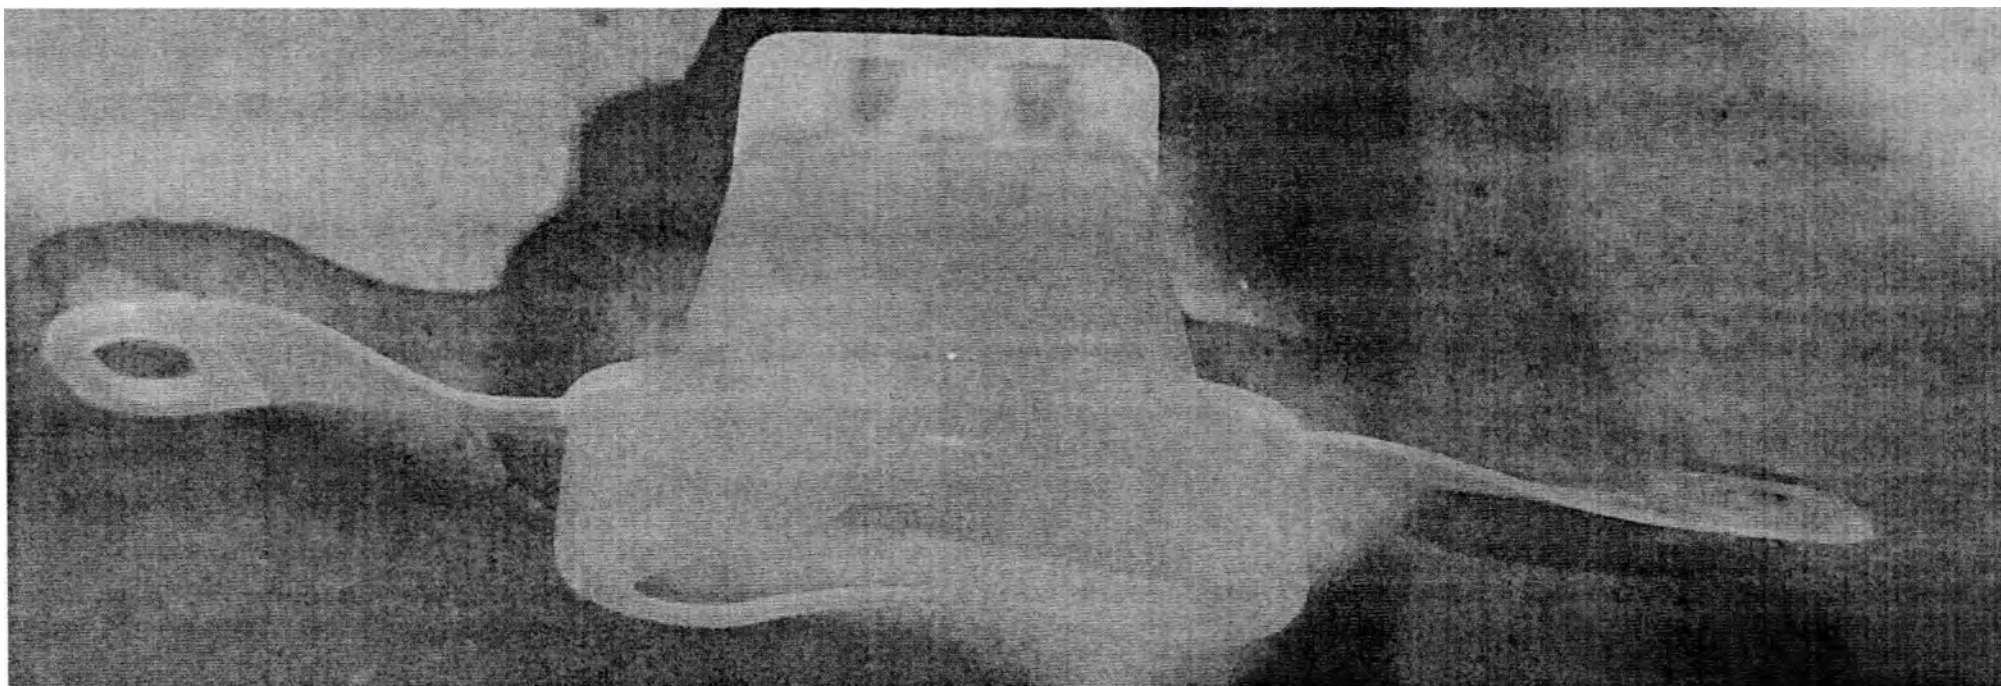


35.2 Маски одноразовые, размер L, 1200-06, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

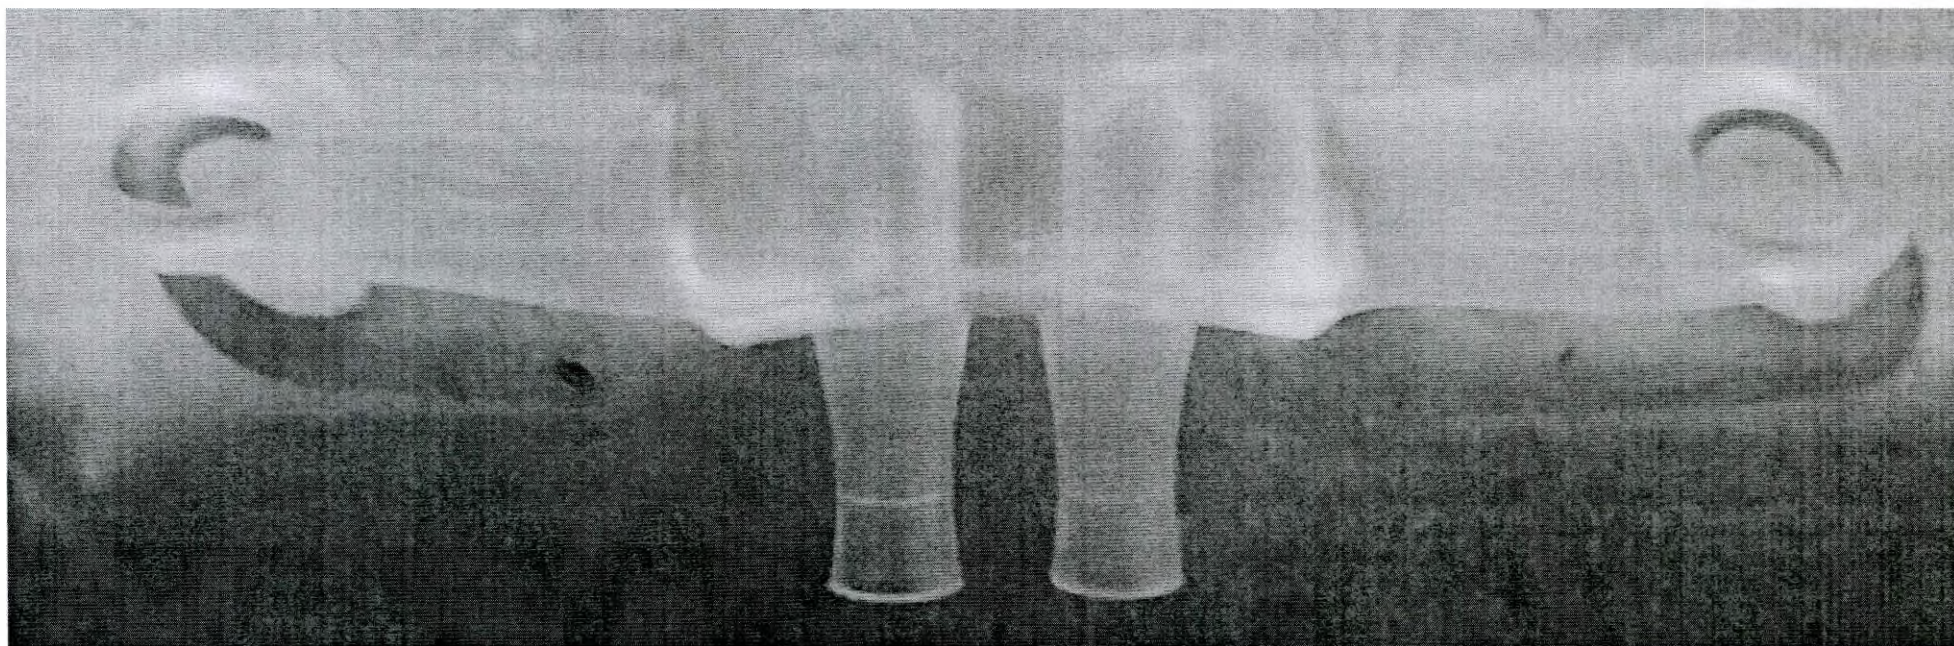


35.3 Канюли одноразовые, размер S, 1200-21, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

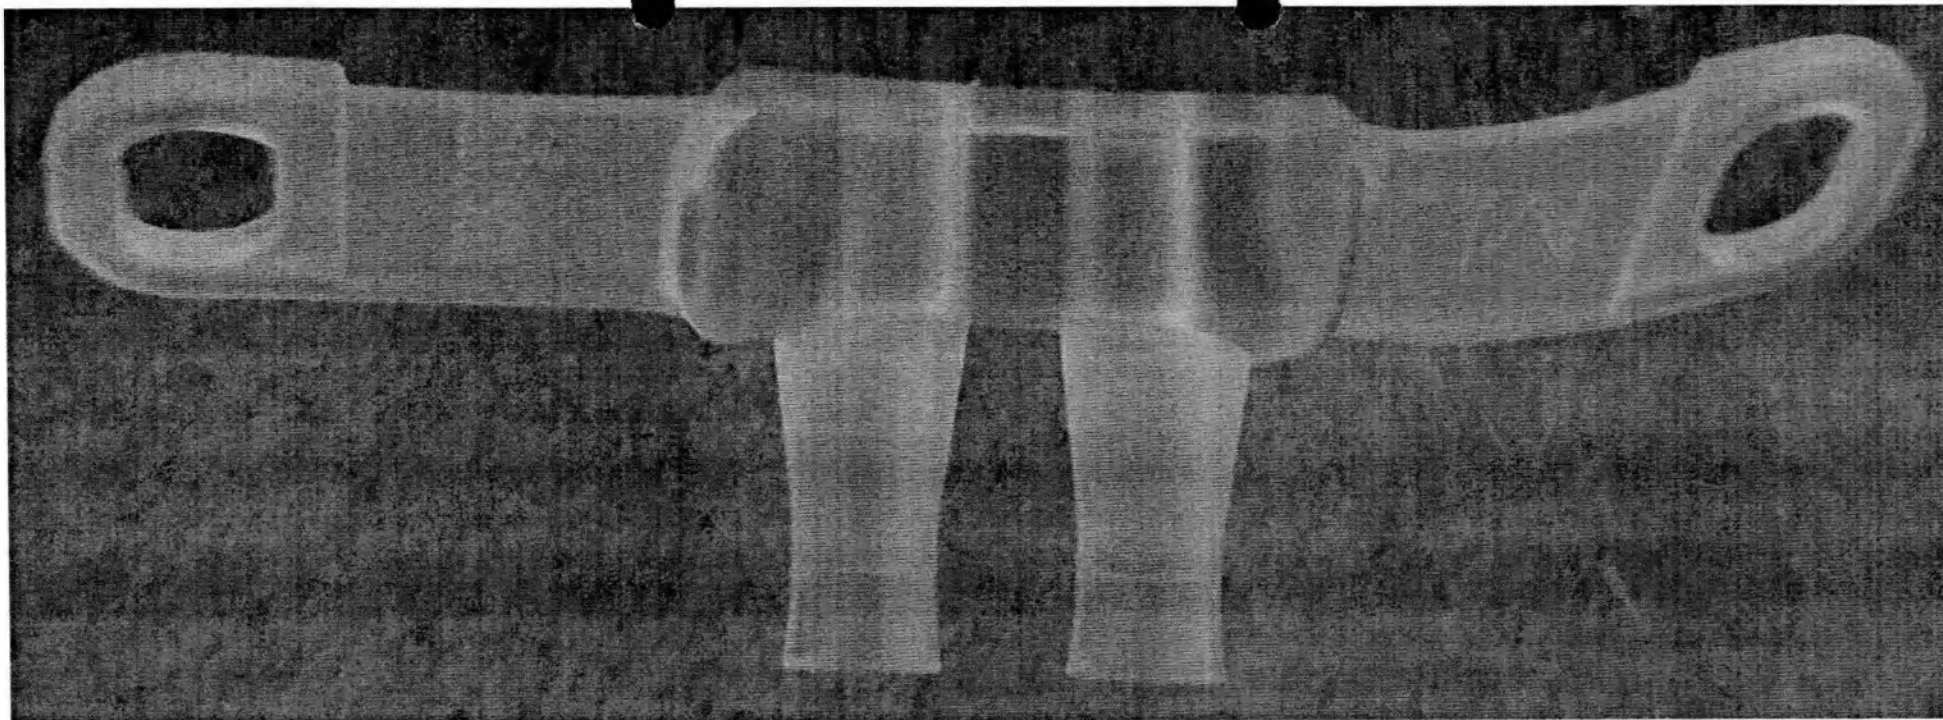


35.3 Канюли одноразовые, размер М, 1200-02, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

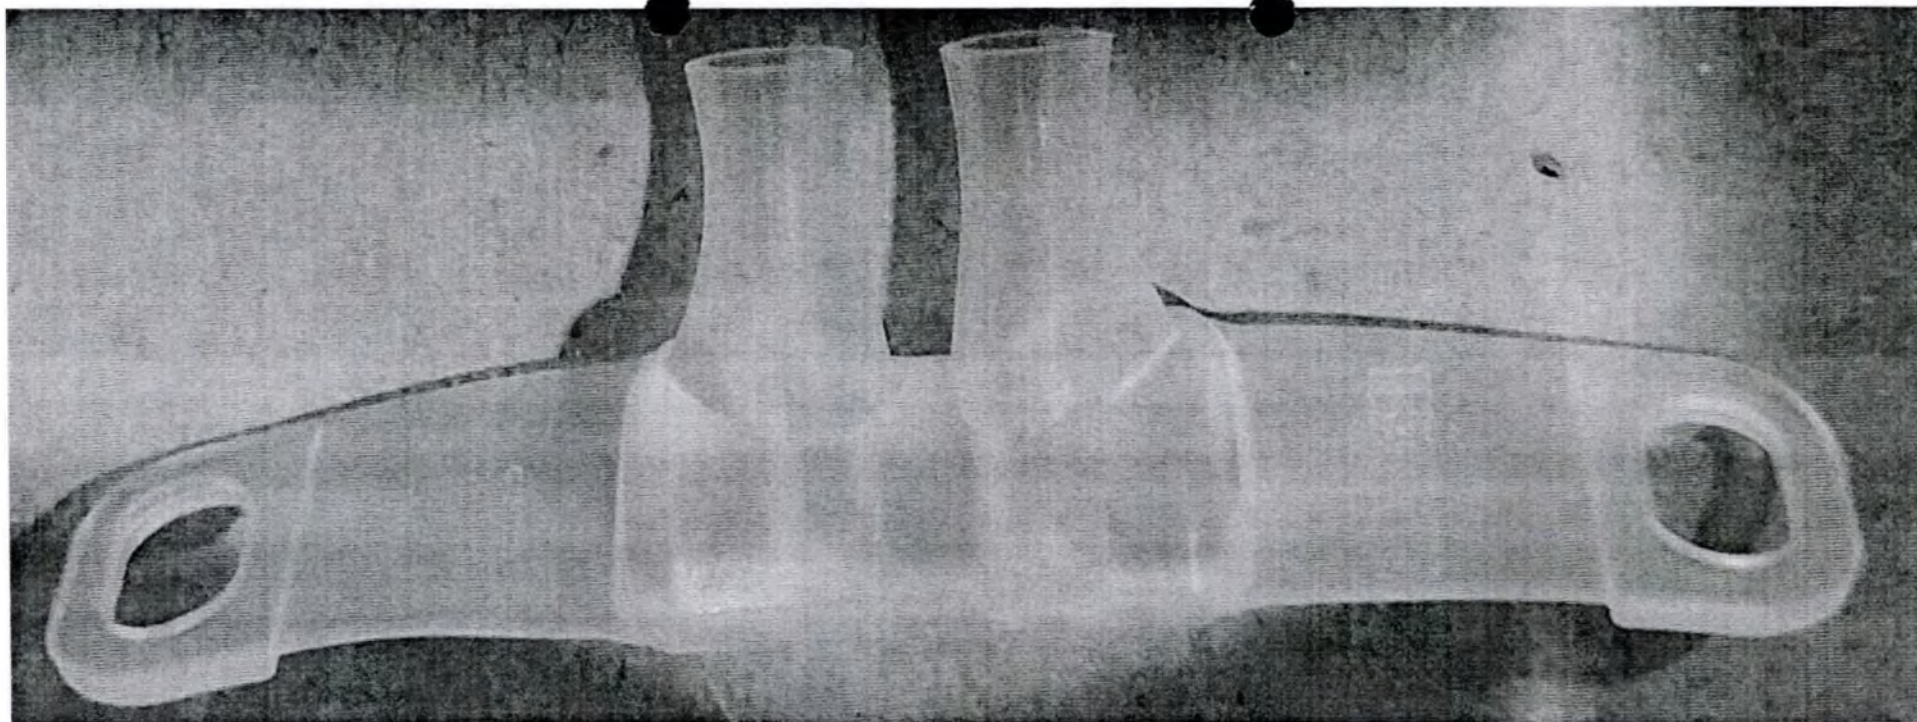

35.3 Канюли одноразовые, размер L, 1200-22, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

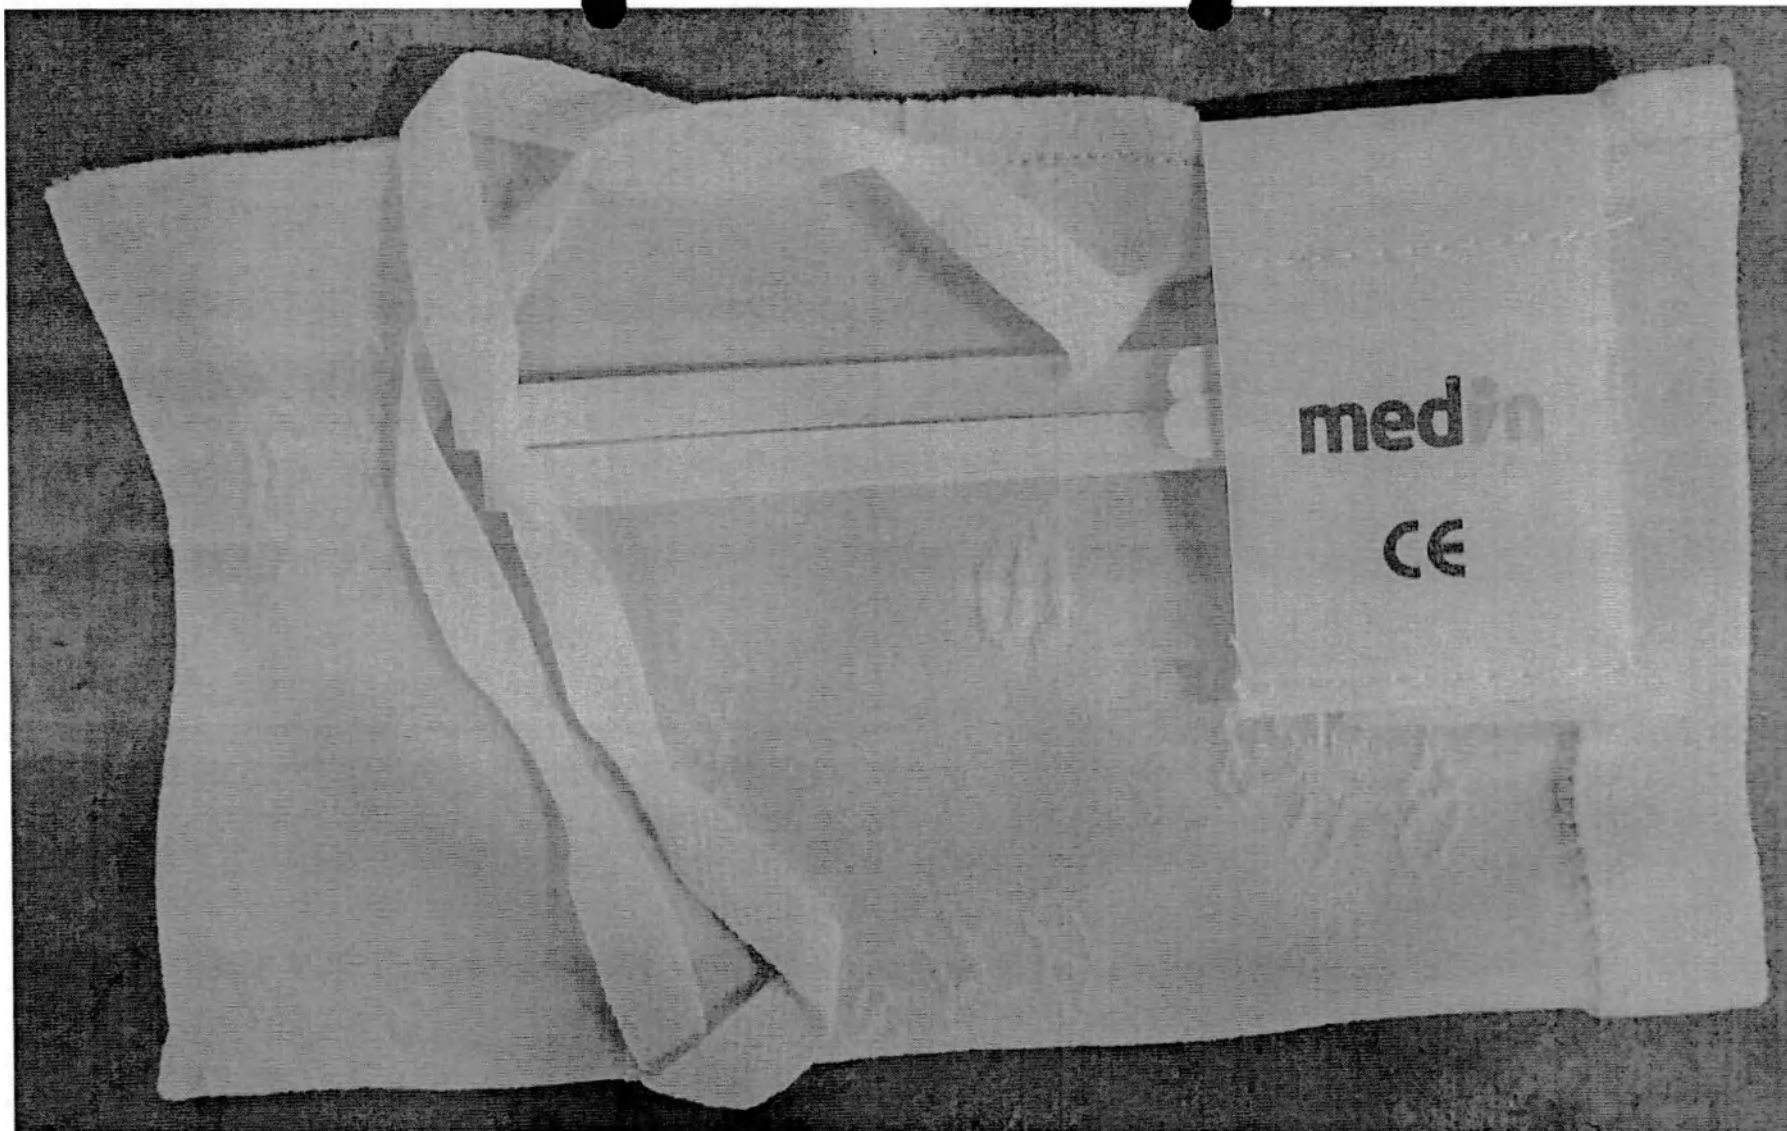


35.4 Шапочки одноразовые, размер S, 1215-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

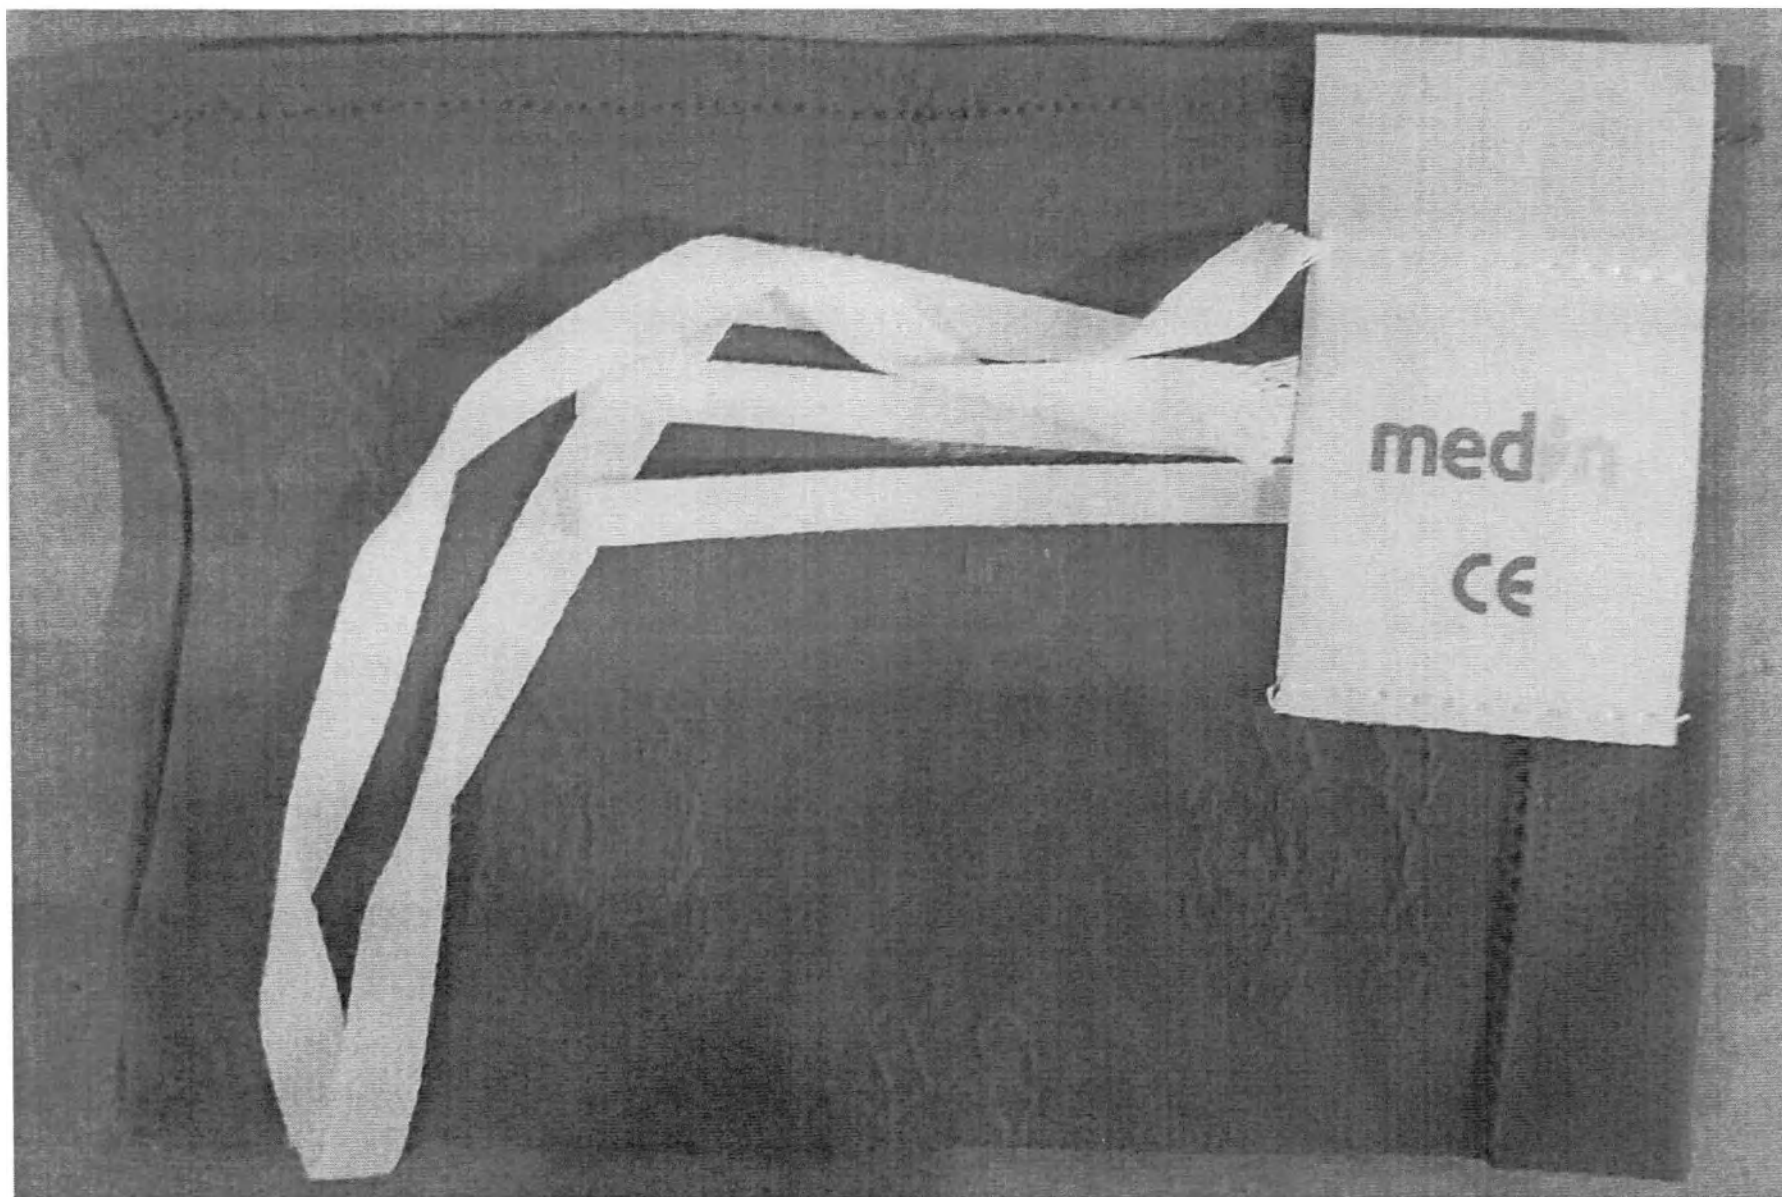


35.4 Шапочки одноразовые, размер М, 1216-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




35.4 Шапочки одноразовые, размер L, 1217-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

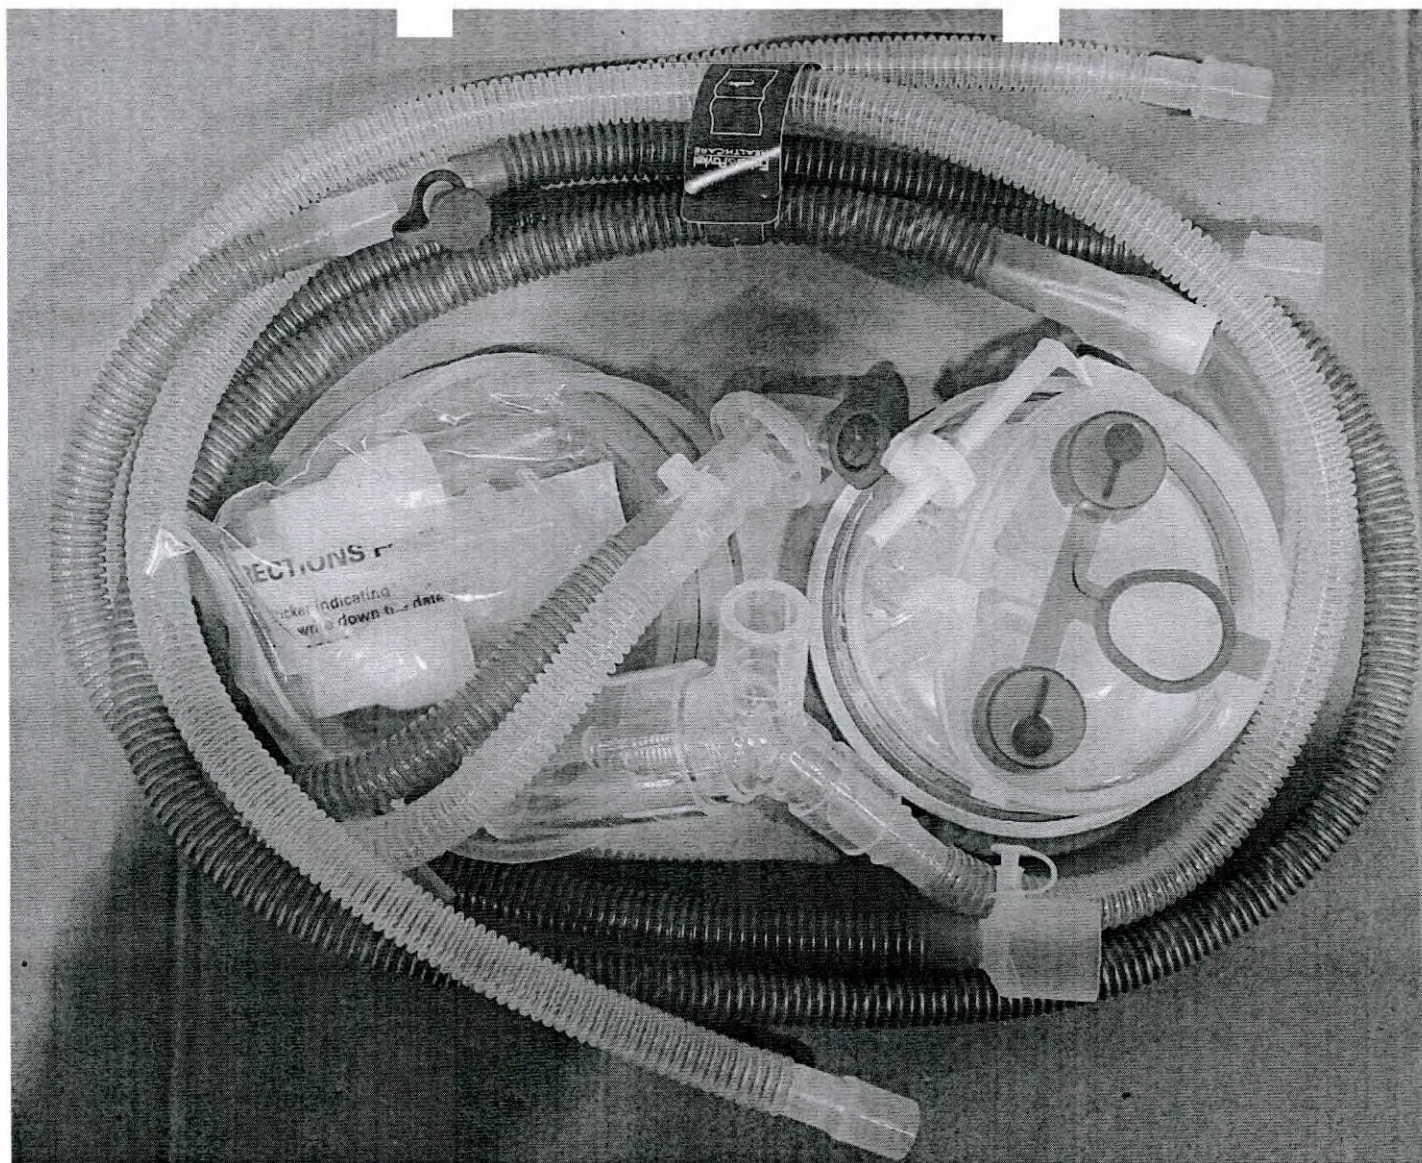

35.5 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: - RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.), в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

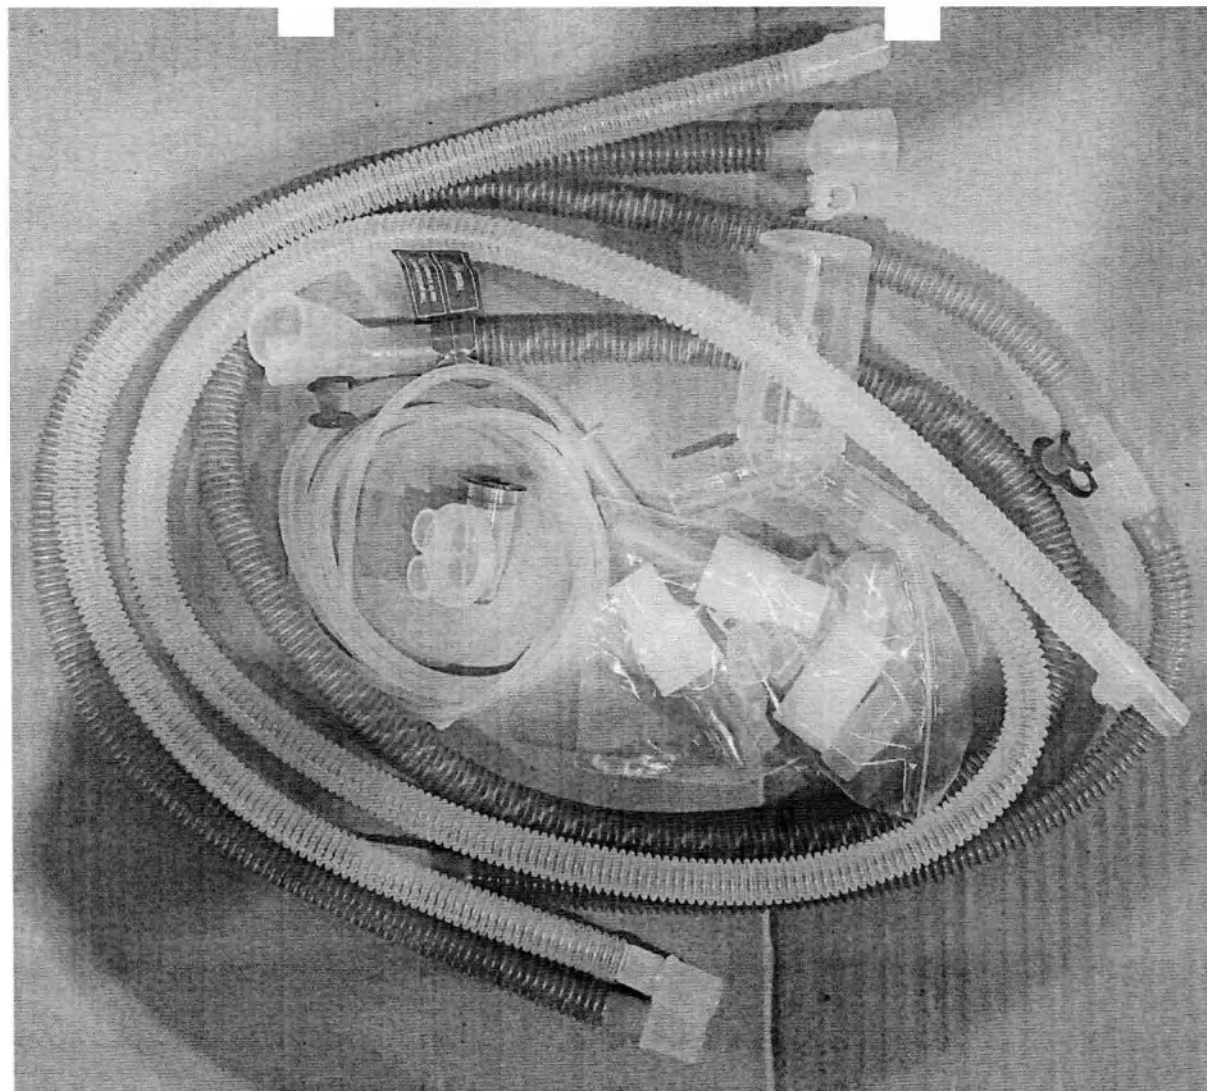


35.5 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: - RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.), в составе Набора для nIMV, TECH.233012, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

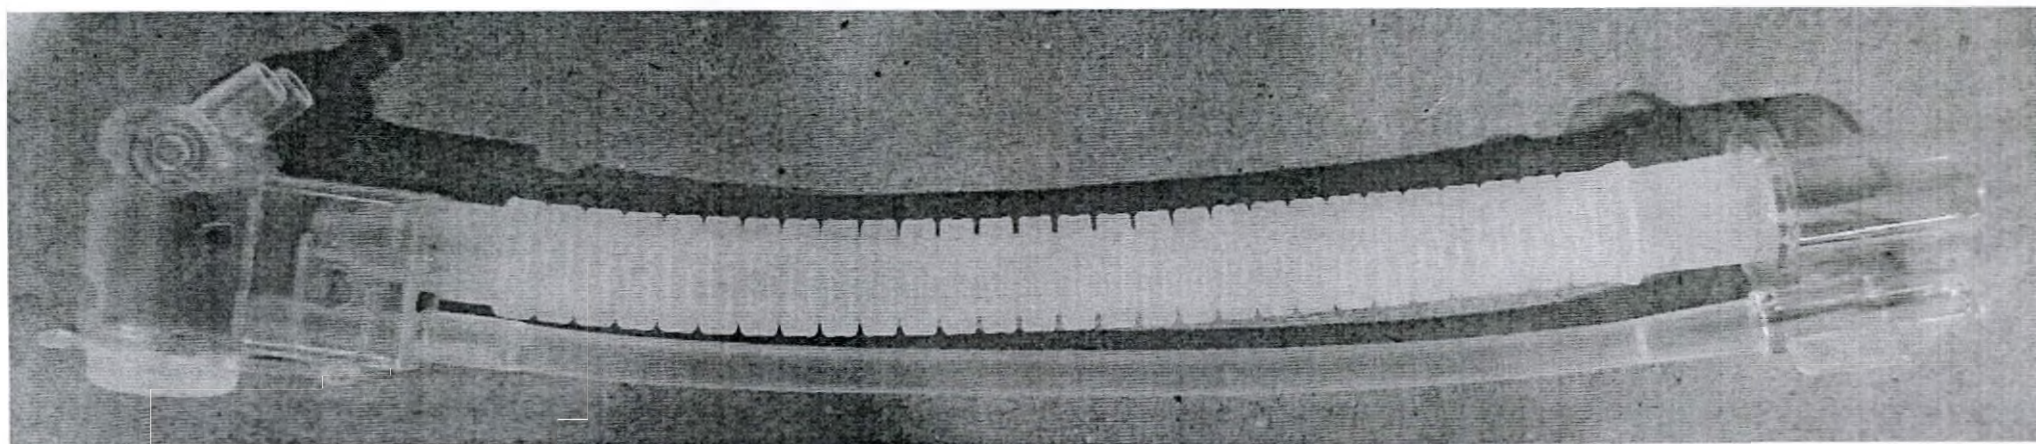


36 Генератор CPAP Medijet® одноразовый, 1000, medin Medical Innovations GmbH, Германия


37 Набор для nCP. medin, TUCH.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

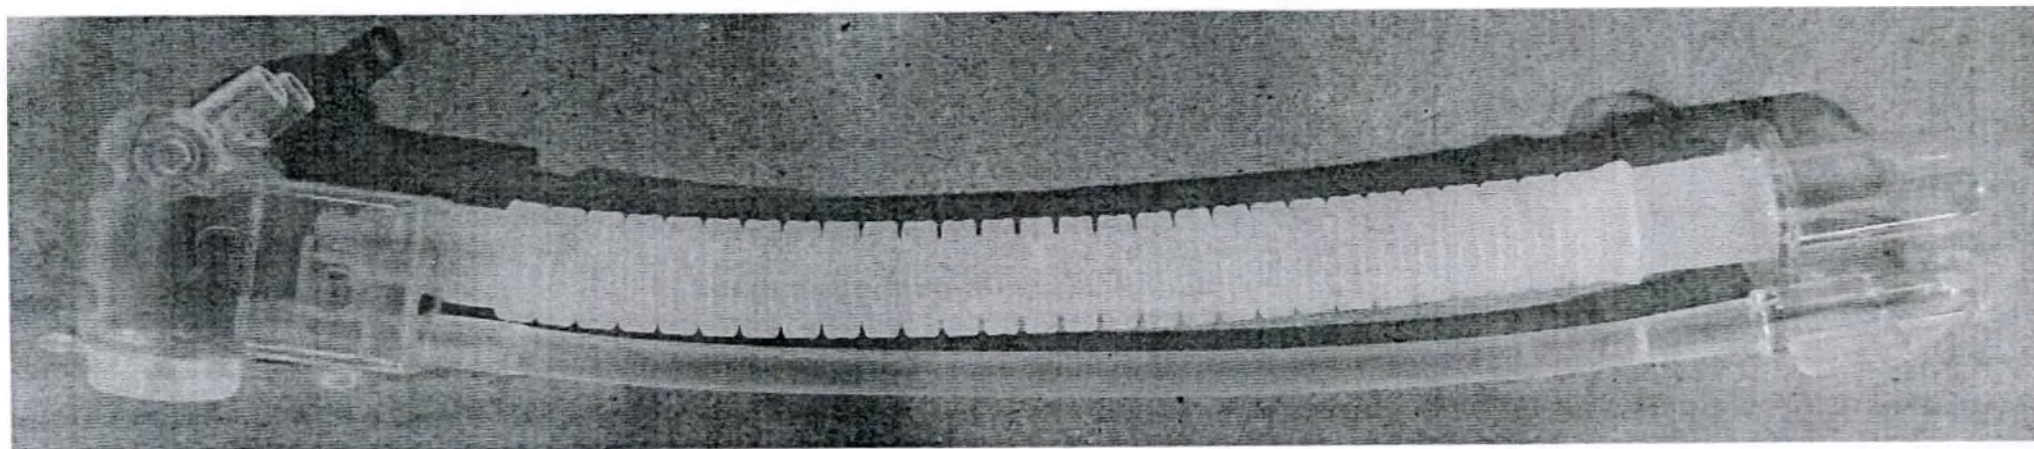


37.1 Генератор CPAP Medijet® одноразовый, 1000, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, TUCH.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

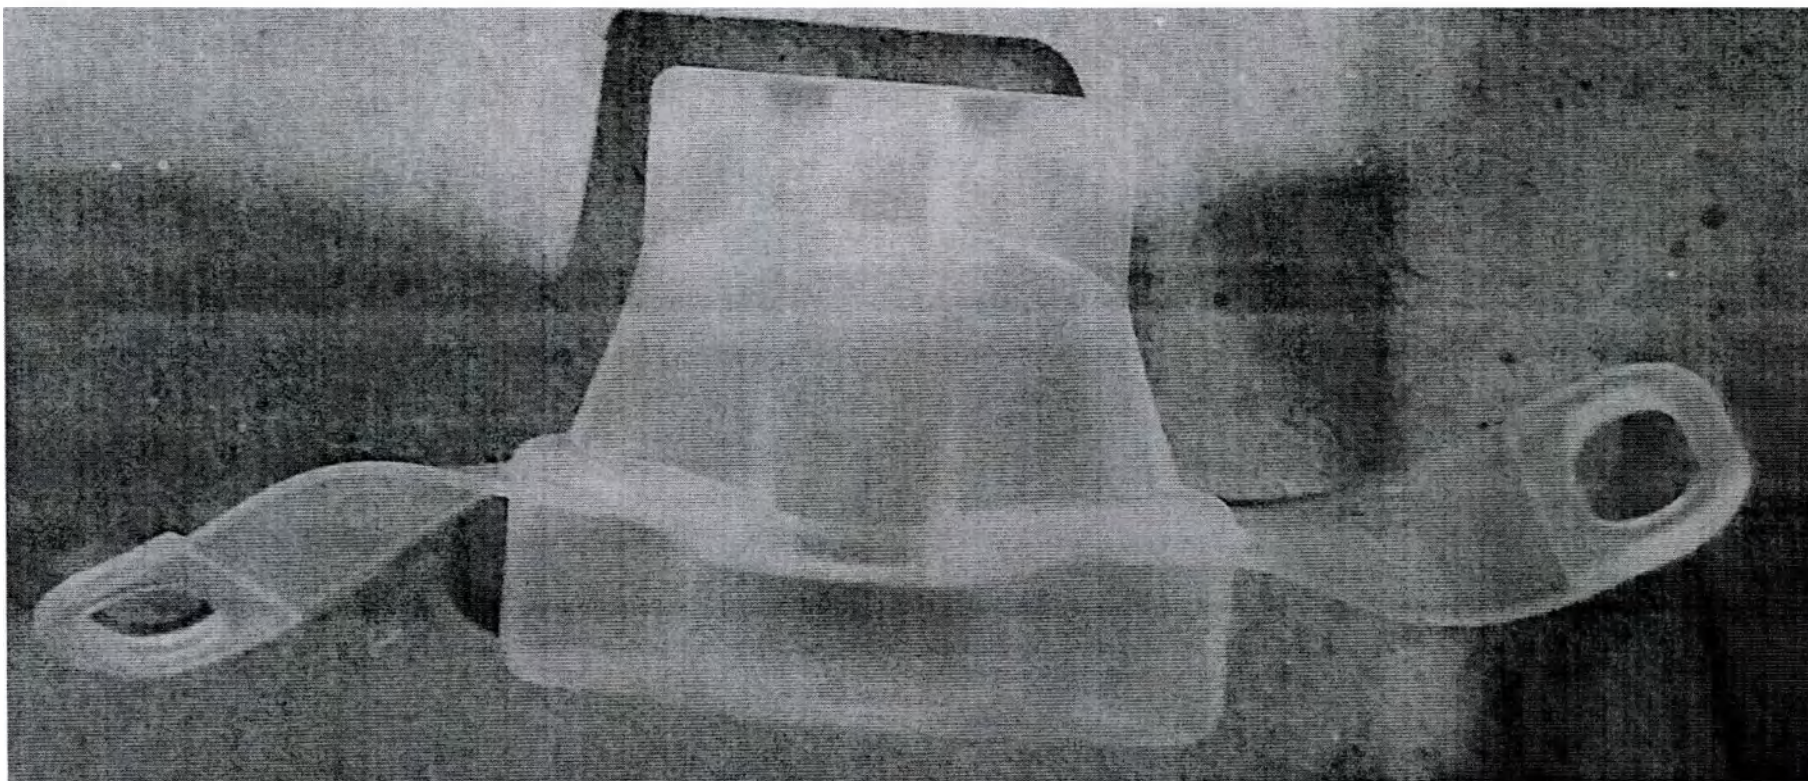


37.2 Маски одноразовые, размер S, 1200-04, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для пСРАР Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

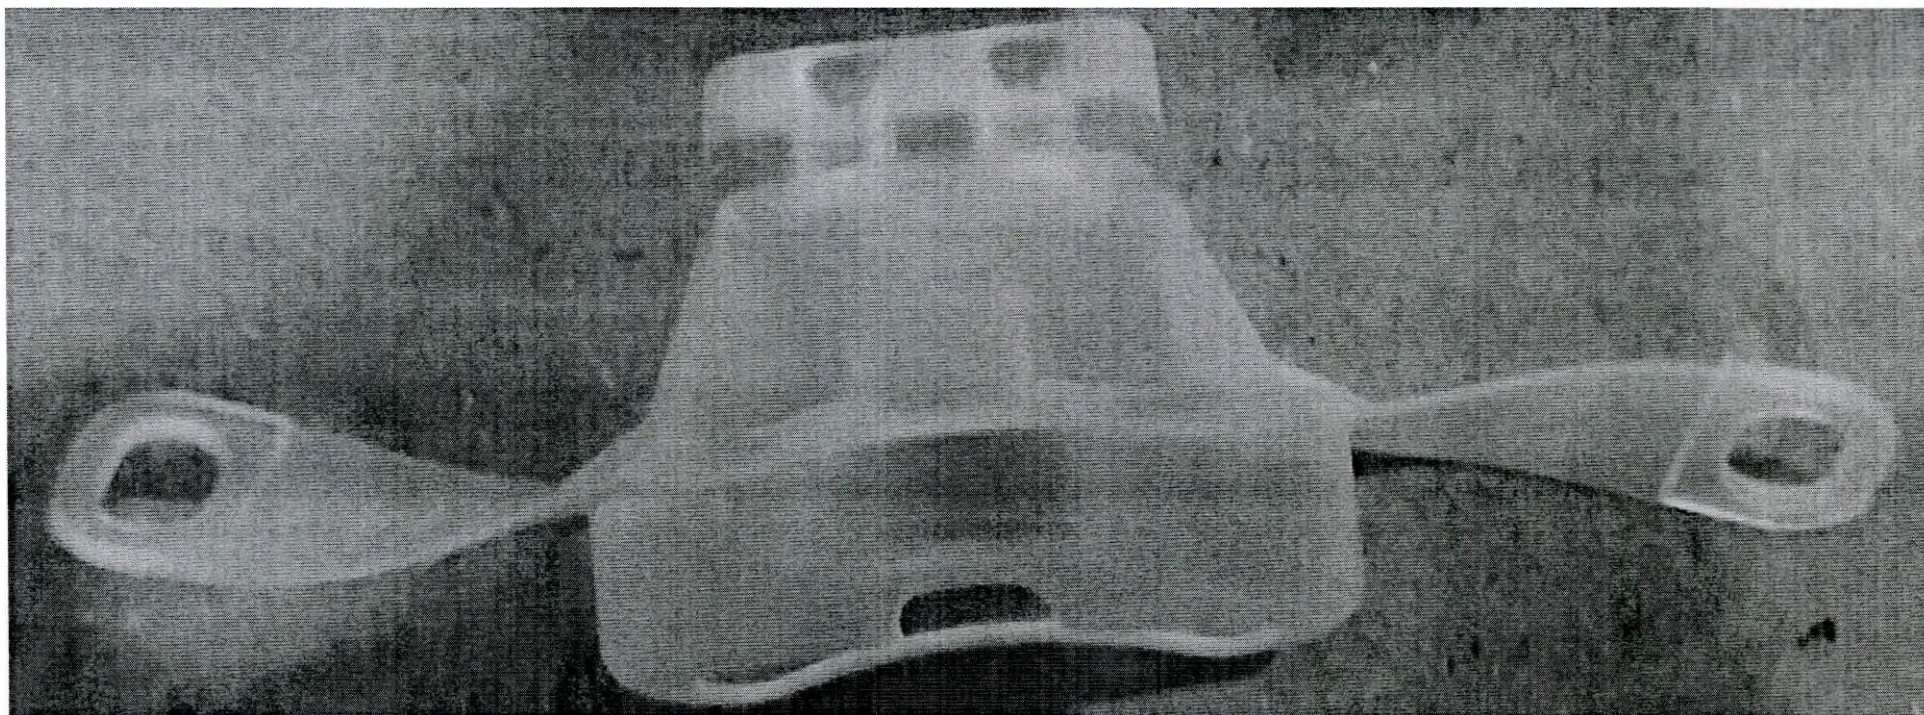


37.2 Маски одноразовые, размер М, 1200-05, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

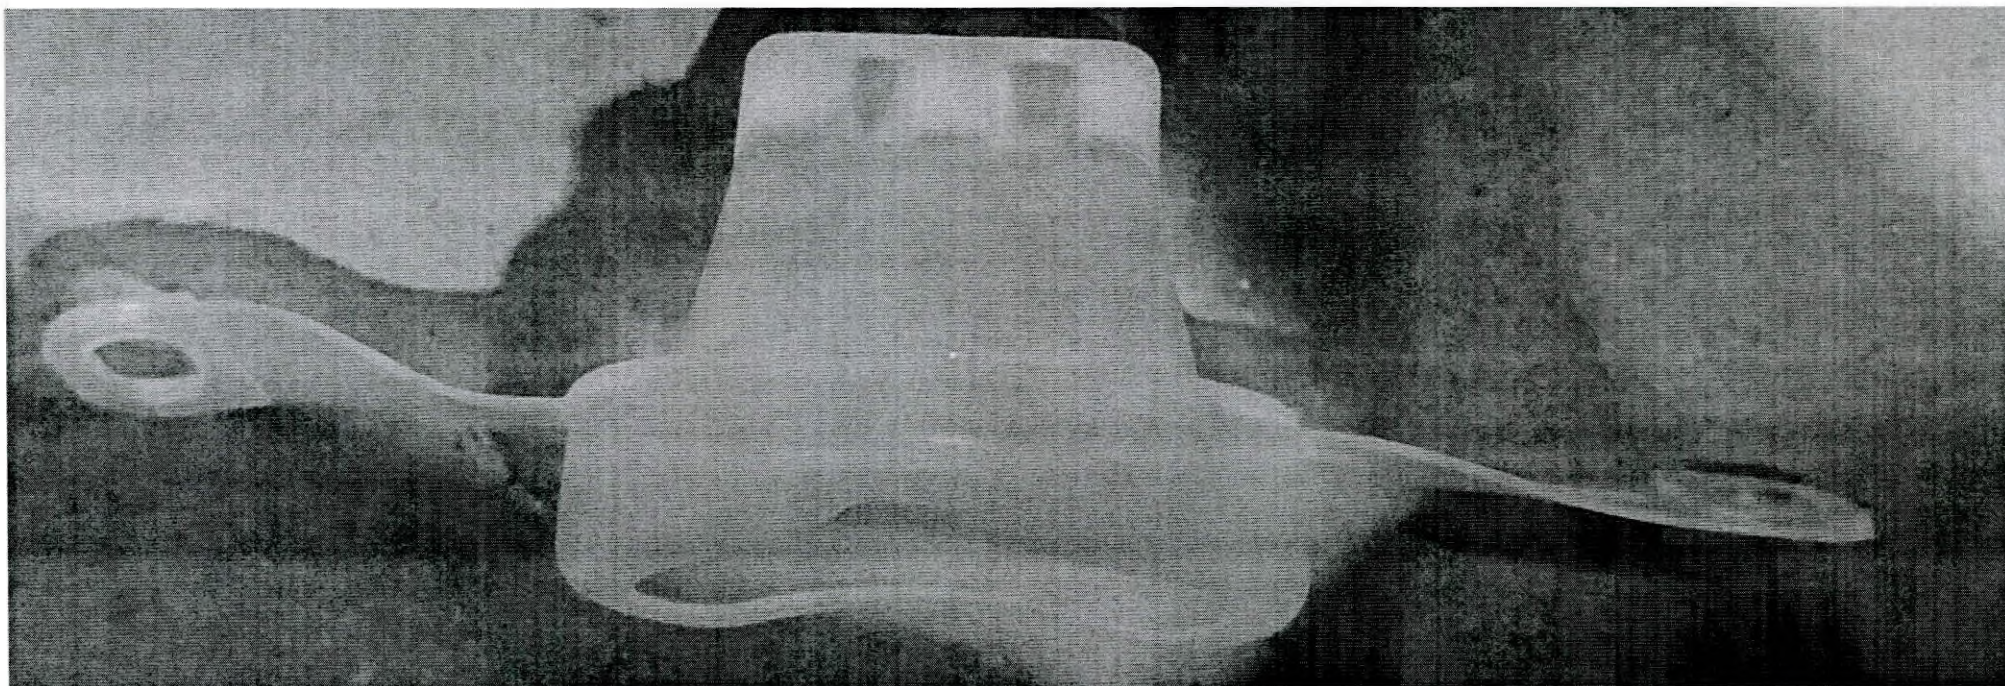


37.2 Маски одноразовые, размер L, 1200-06, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

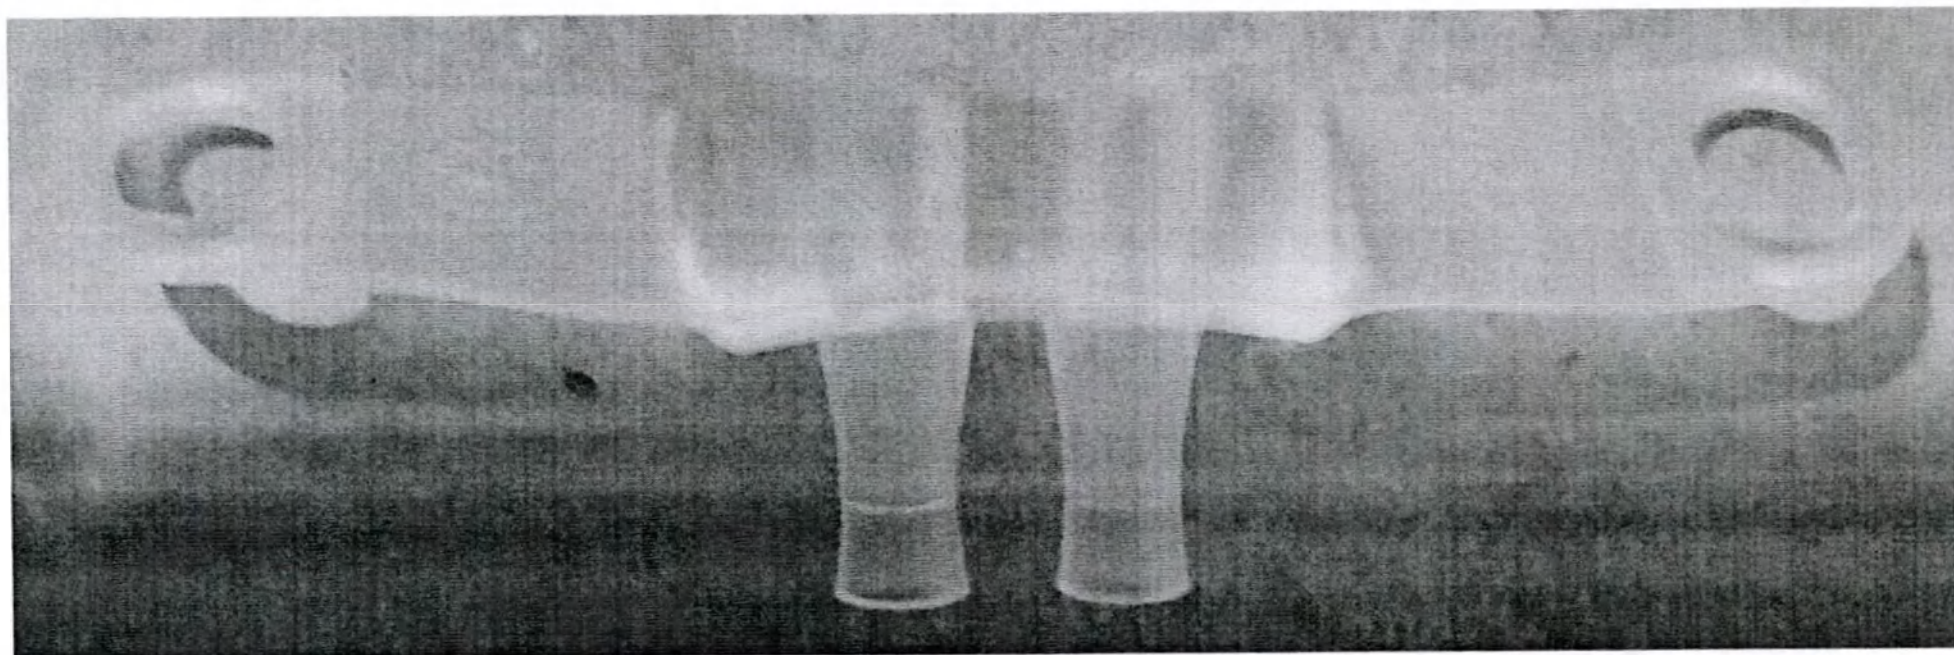


37.3 Канюли одноразовые, размер S, 1200-21, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

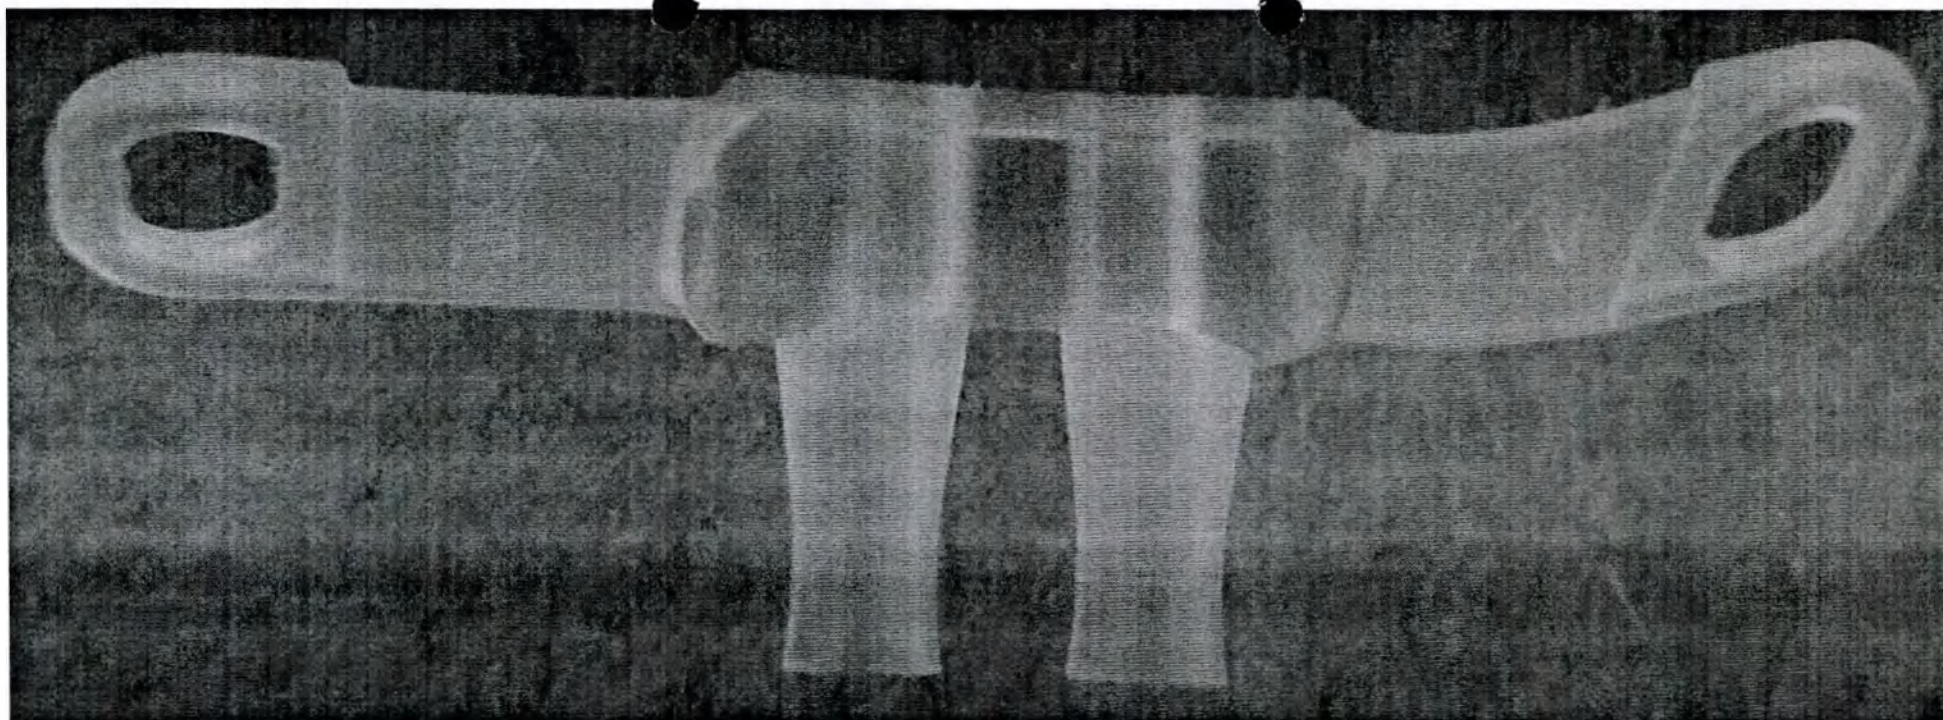


37.3 Канюли одноразовые, размер М, 1200-02, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

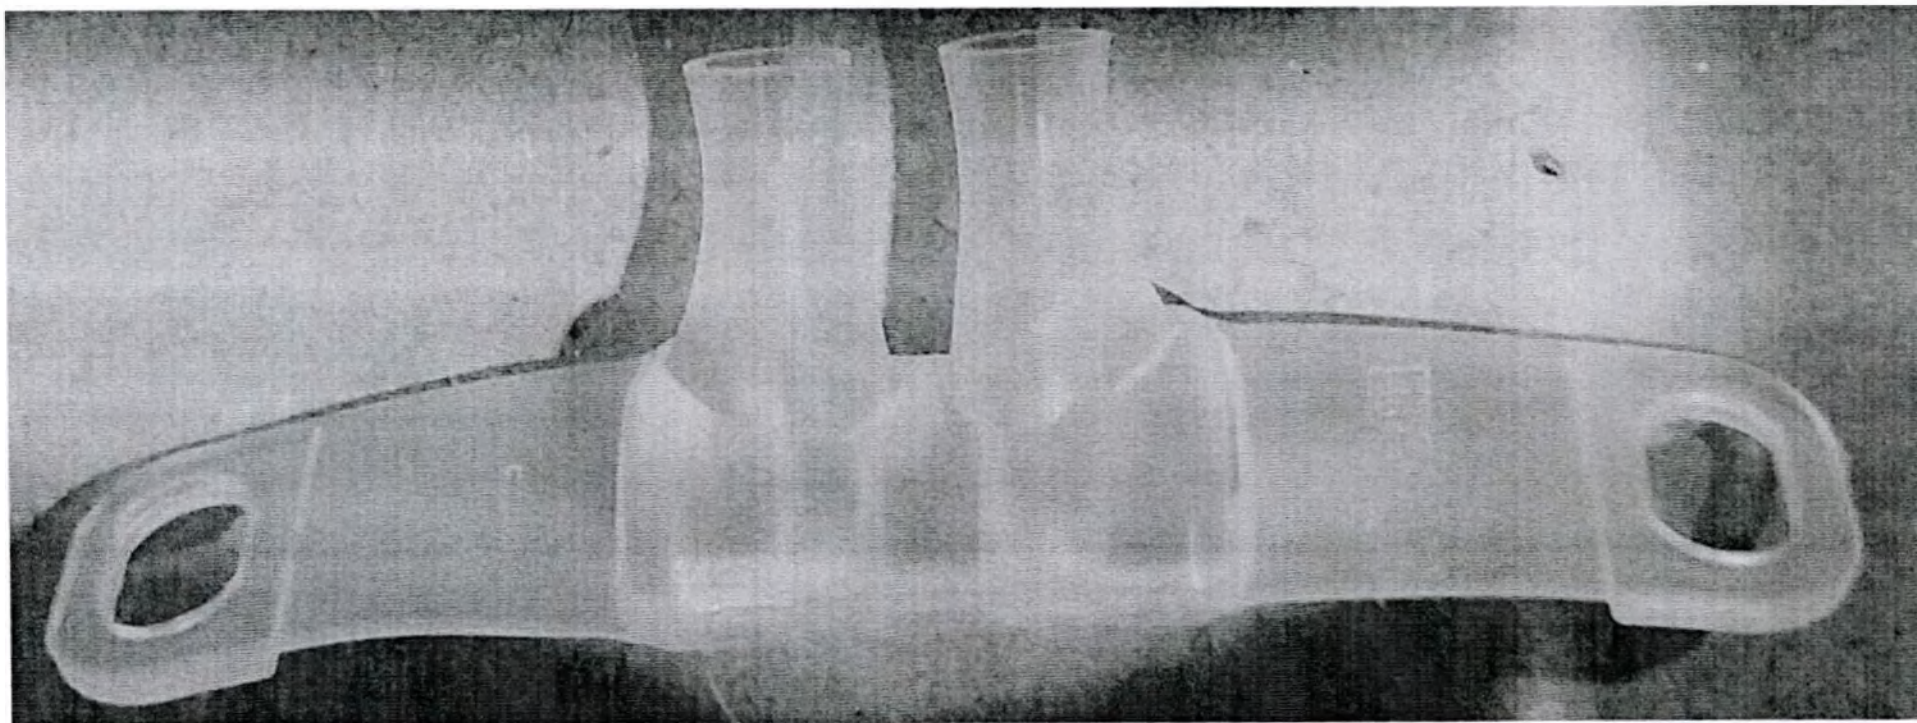


37.3 Канюли одноразовые, размер L, 1200-22, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

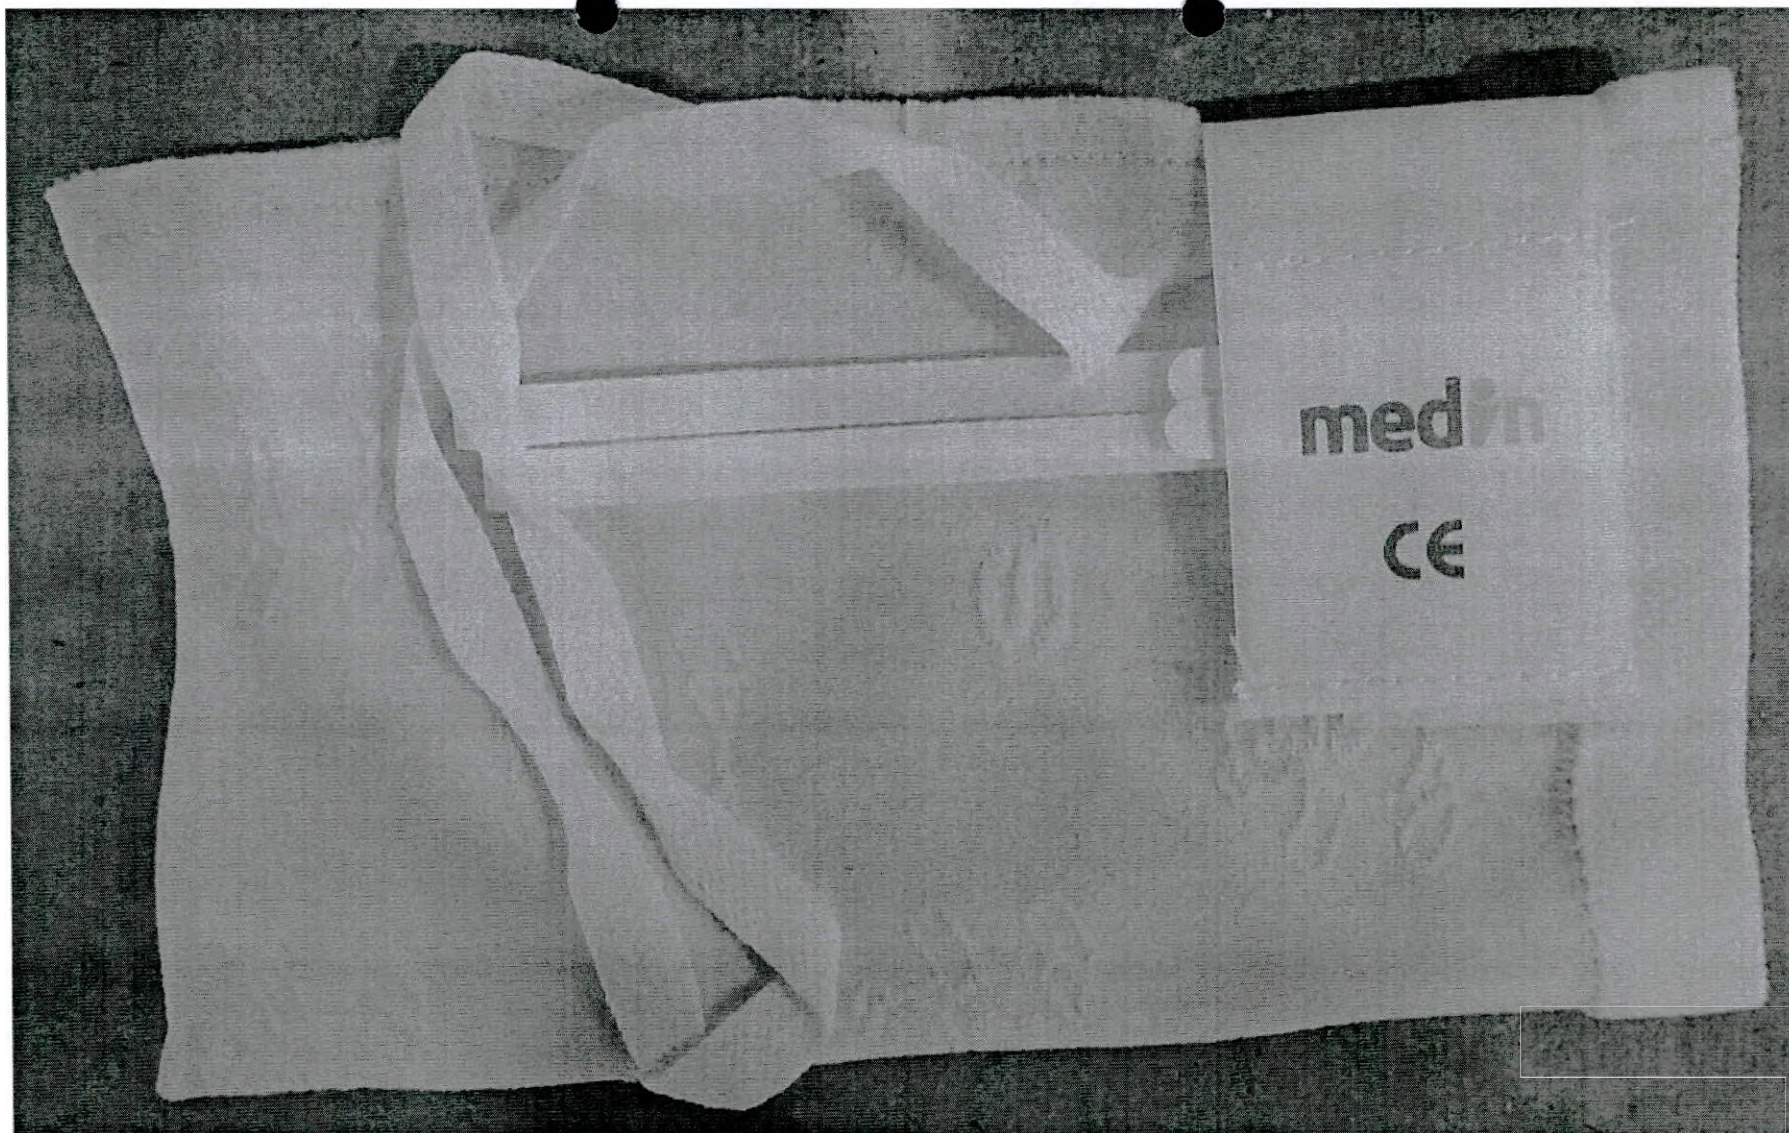


37.4 Шапочки одноразовые, размер S, 1215-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для пСРАР Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

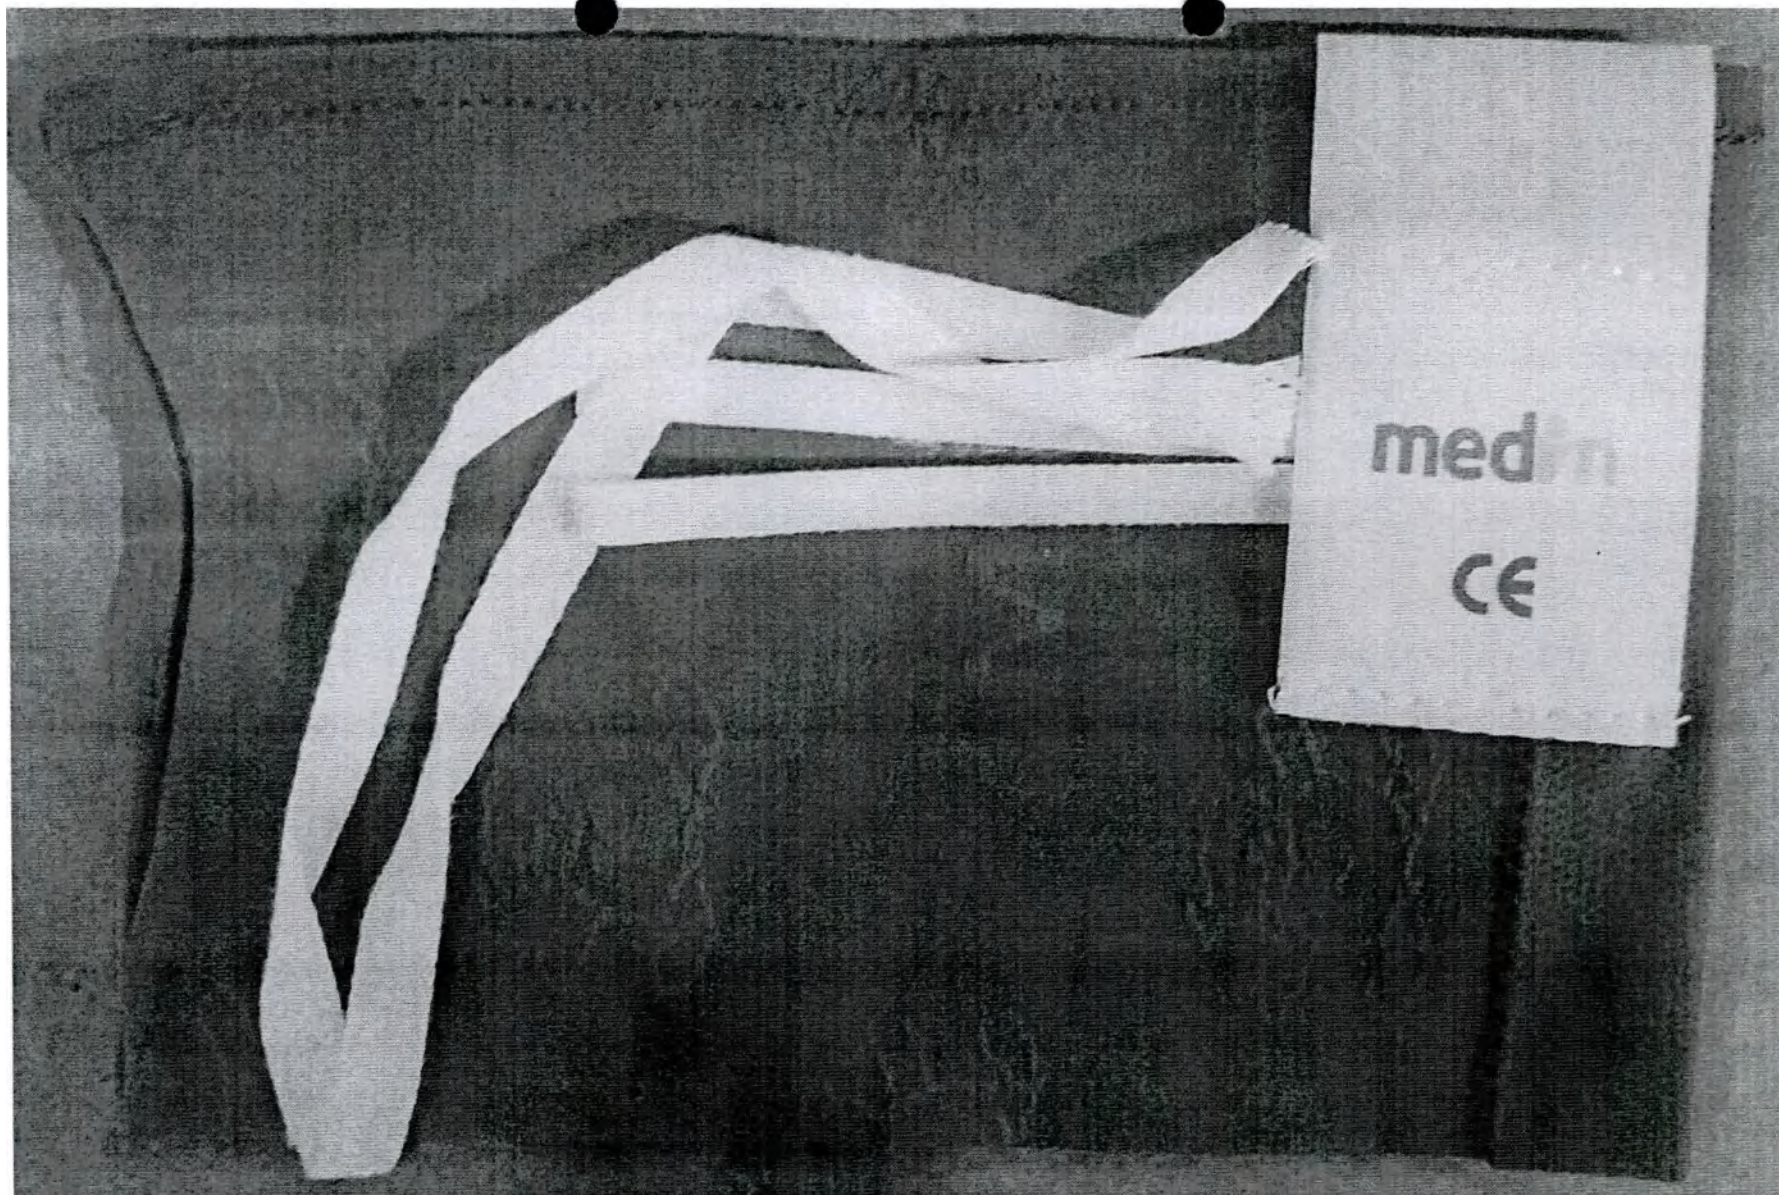


37.4 Шапочки одноразовые, размер М, 1216-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

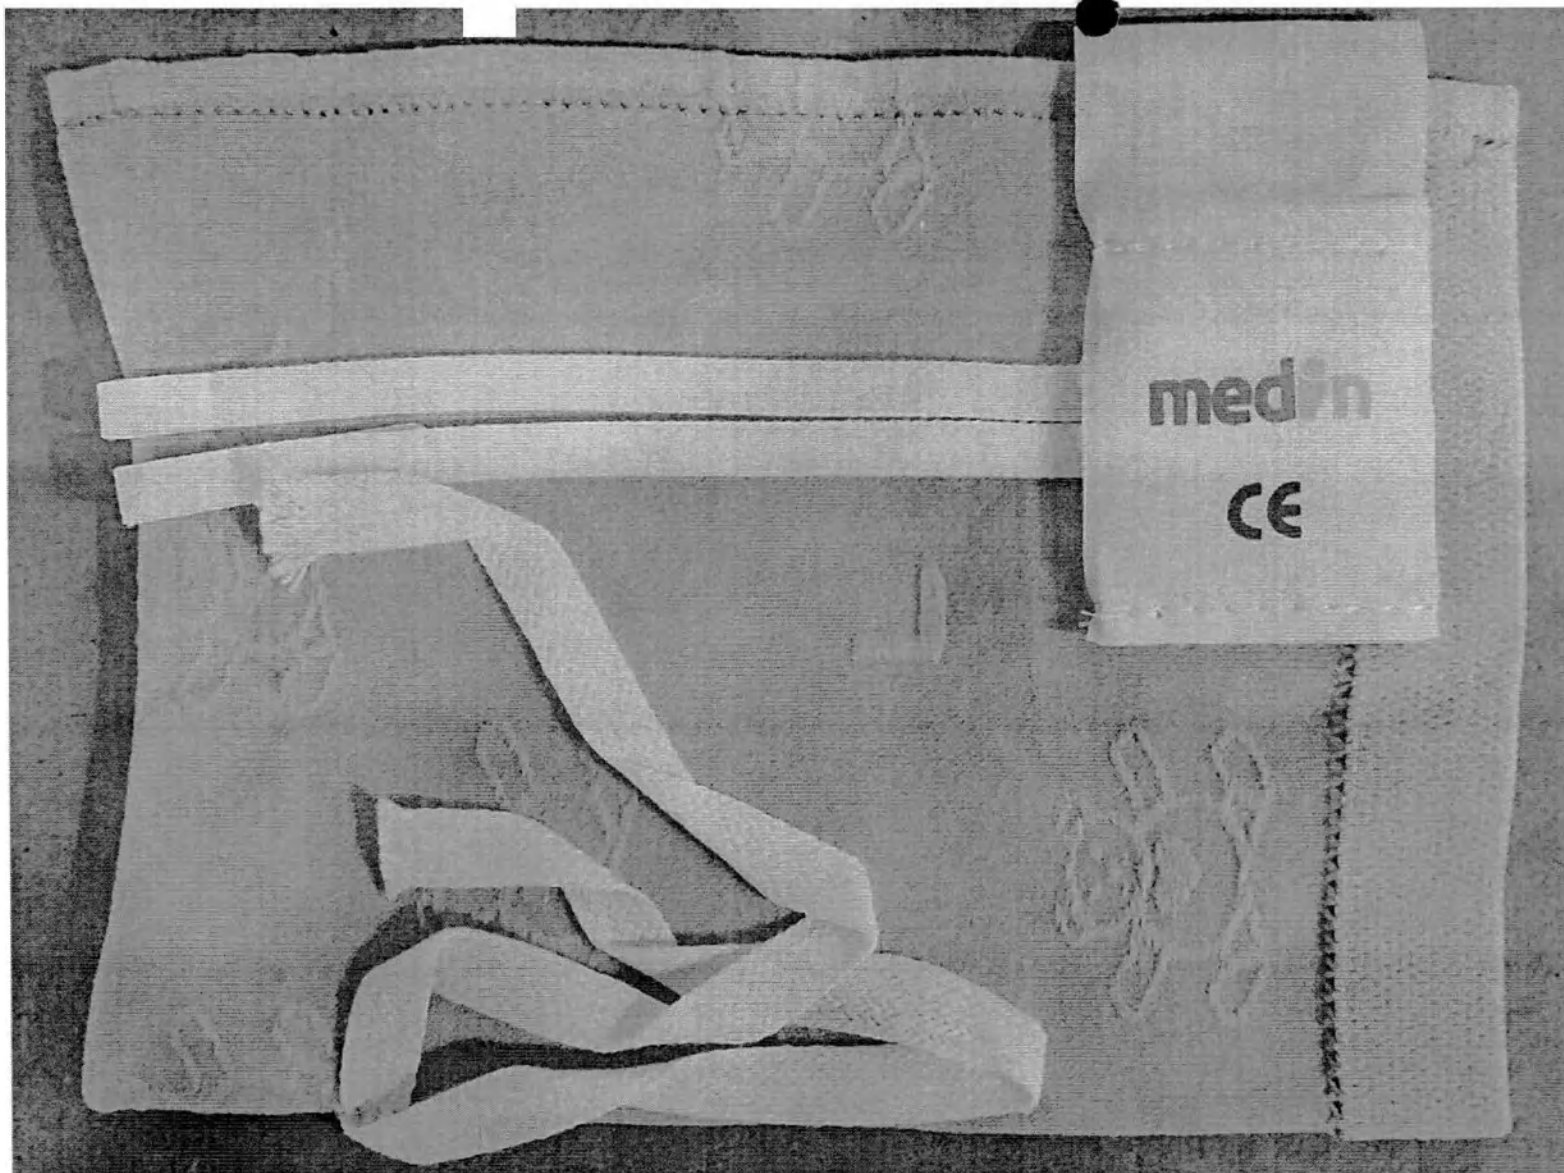


37.4 Шапочки одноразовые, размер L, 1217-10, medin Medical Innovations GmbH, Германия, в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

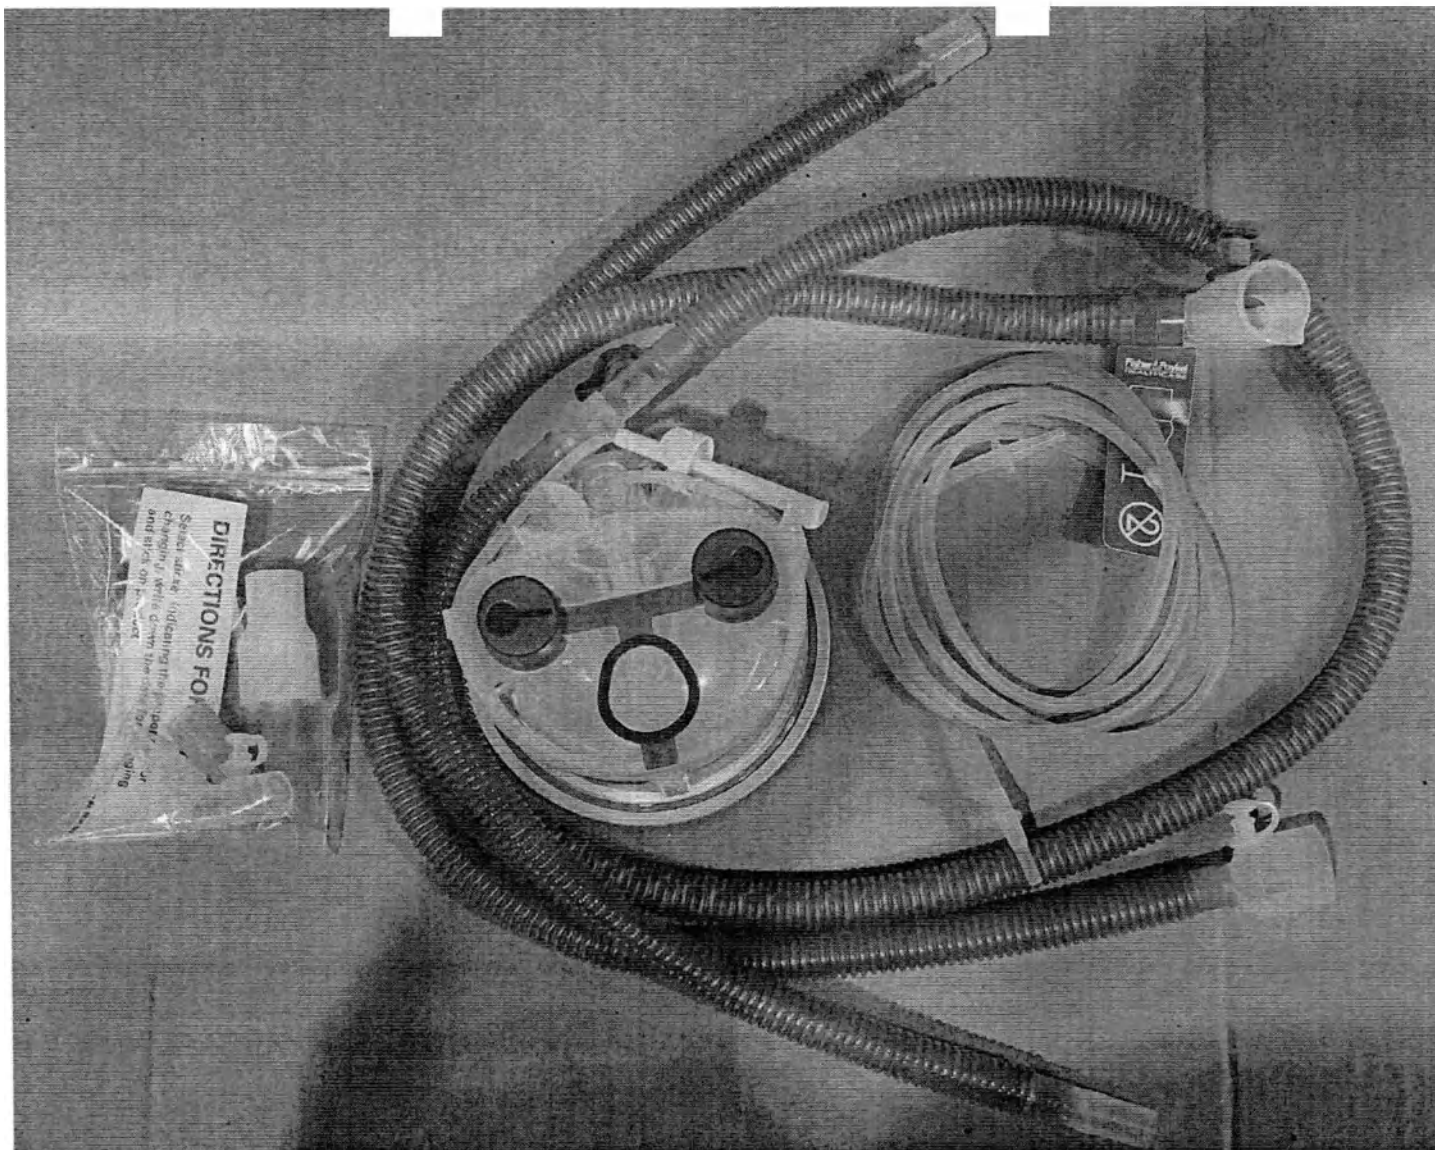


37.5 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: - RT224 – неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.), в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

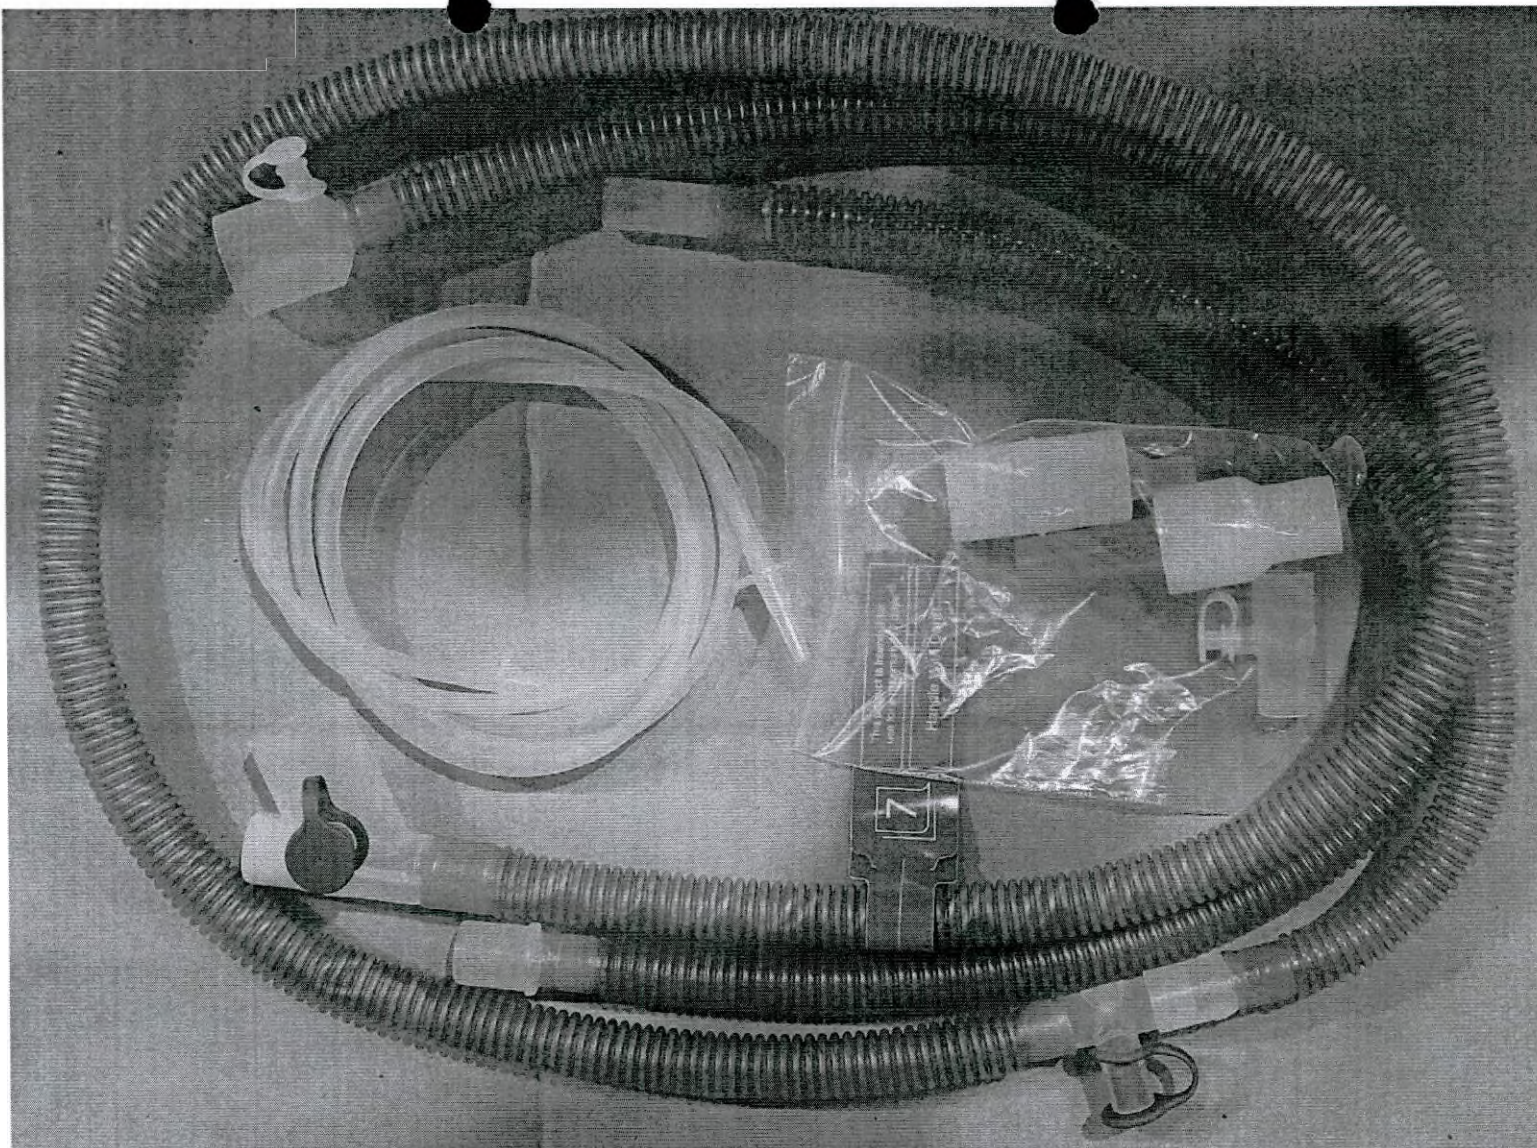


37.5 Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках: RT124 – неонатальный дыхательный контур постоянного потока, РУ № ФСЗ 2011/09111, «Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.», Новая Зеландия (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.), в составе Набора для nCPAP Medin, ТУСН.233013, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

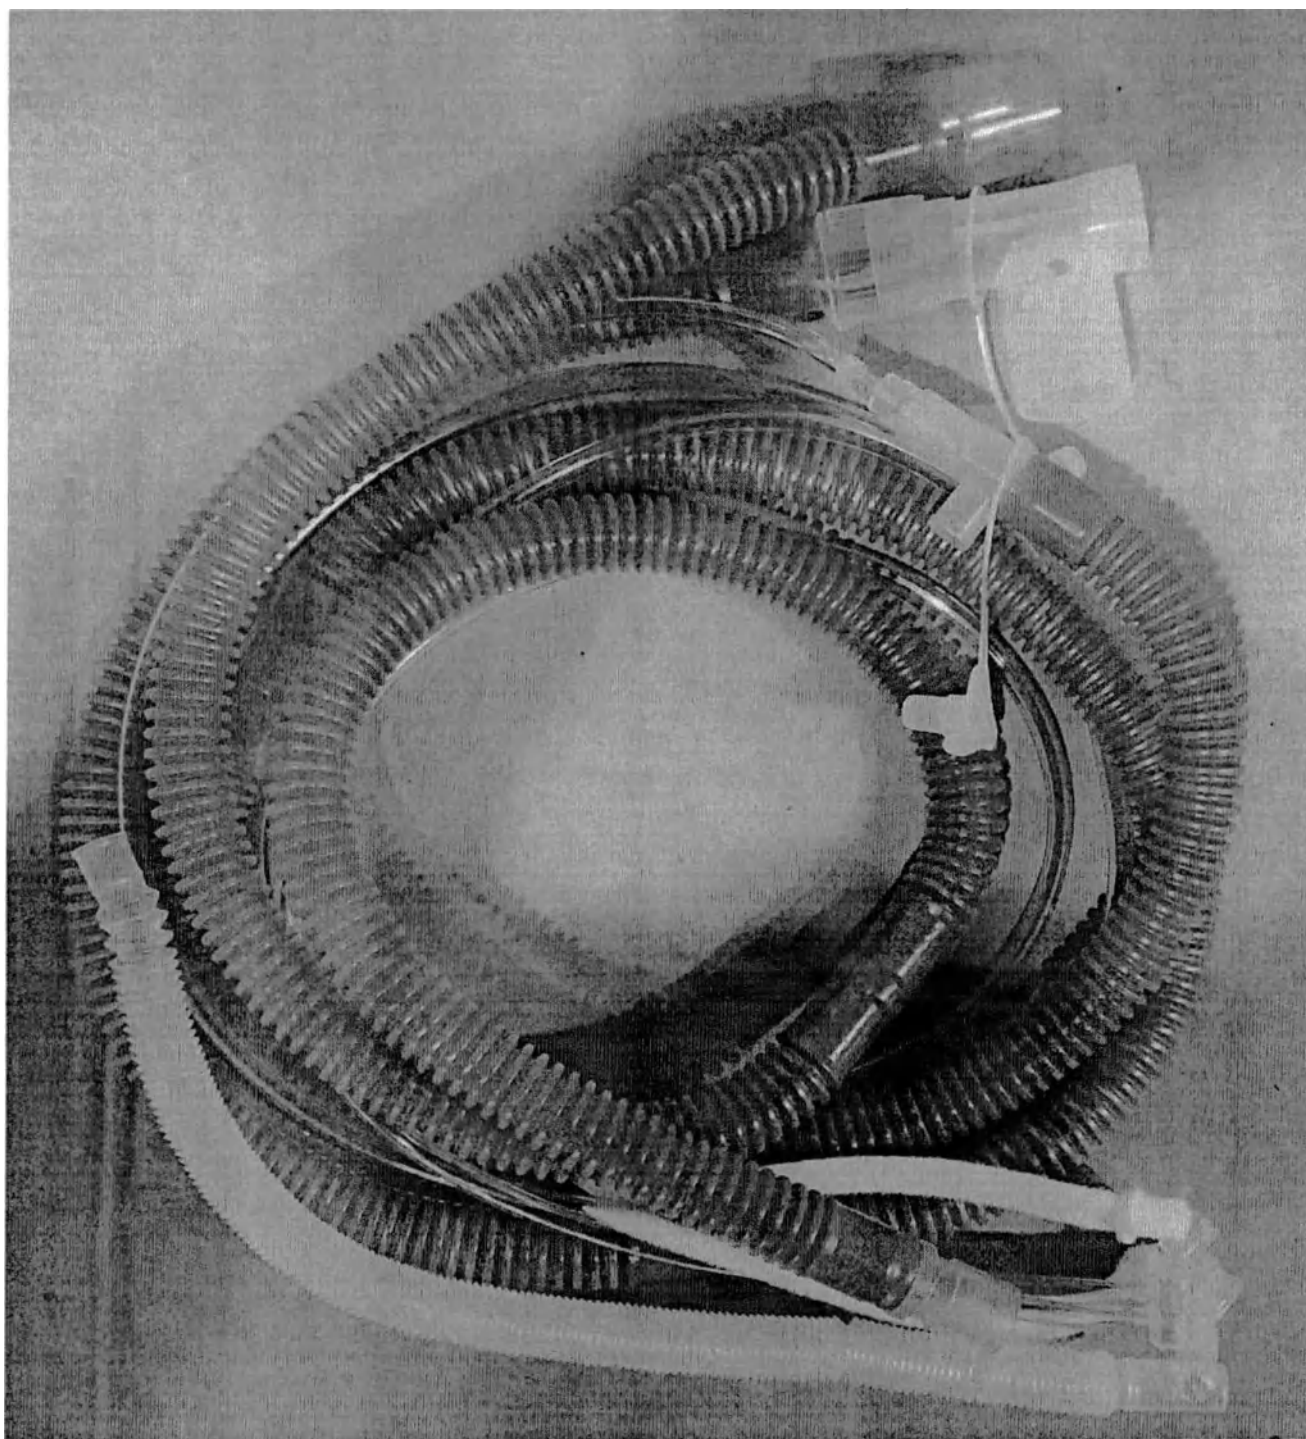

38.1 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом с принадлежностями: шланг дыхательный (1 шт.), генератор потока, линия мониторинга, 4700001, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для пCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

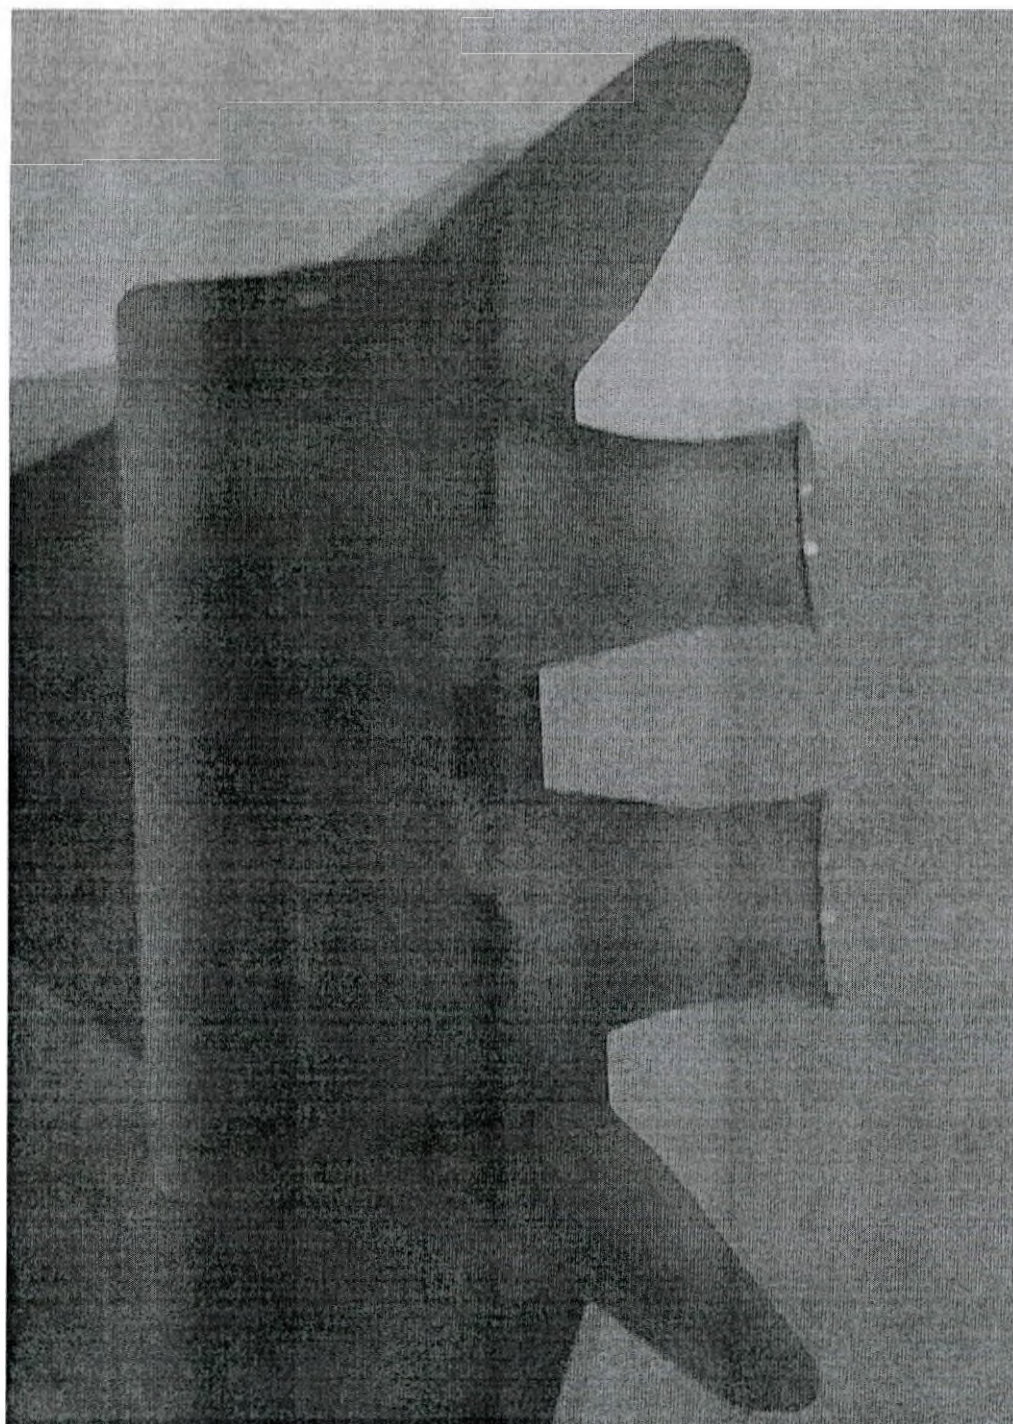


38.2 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: назальные канюли для новорожденных с прямыми зубцами; для назального СРАР, размер S (малый), 4701000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

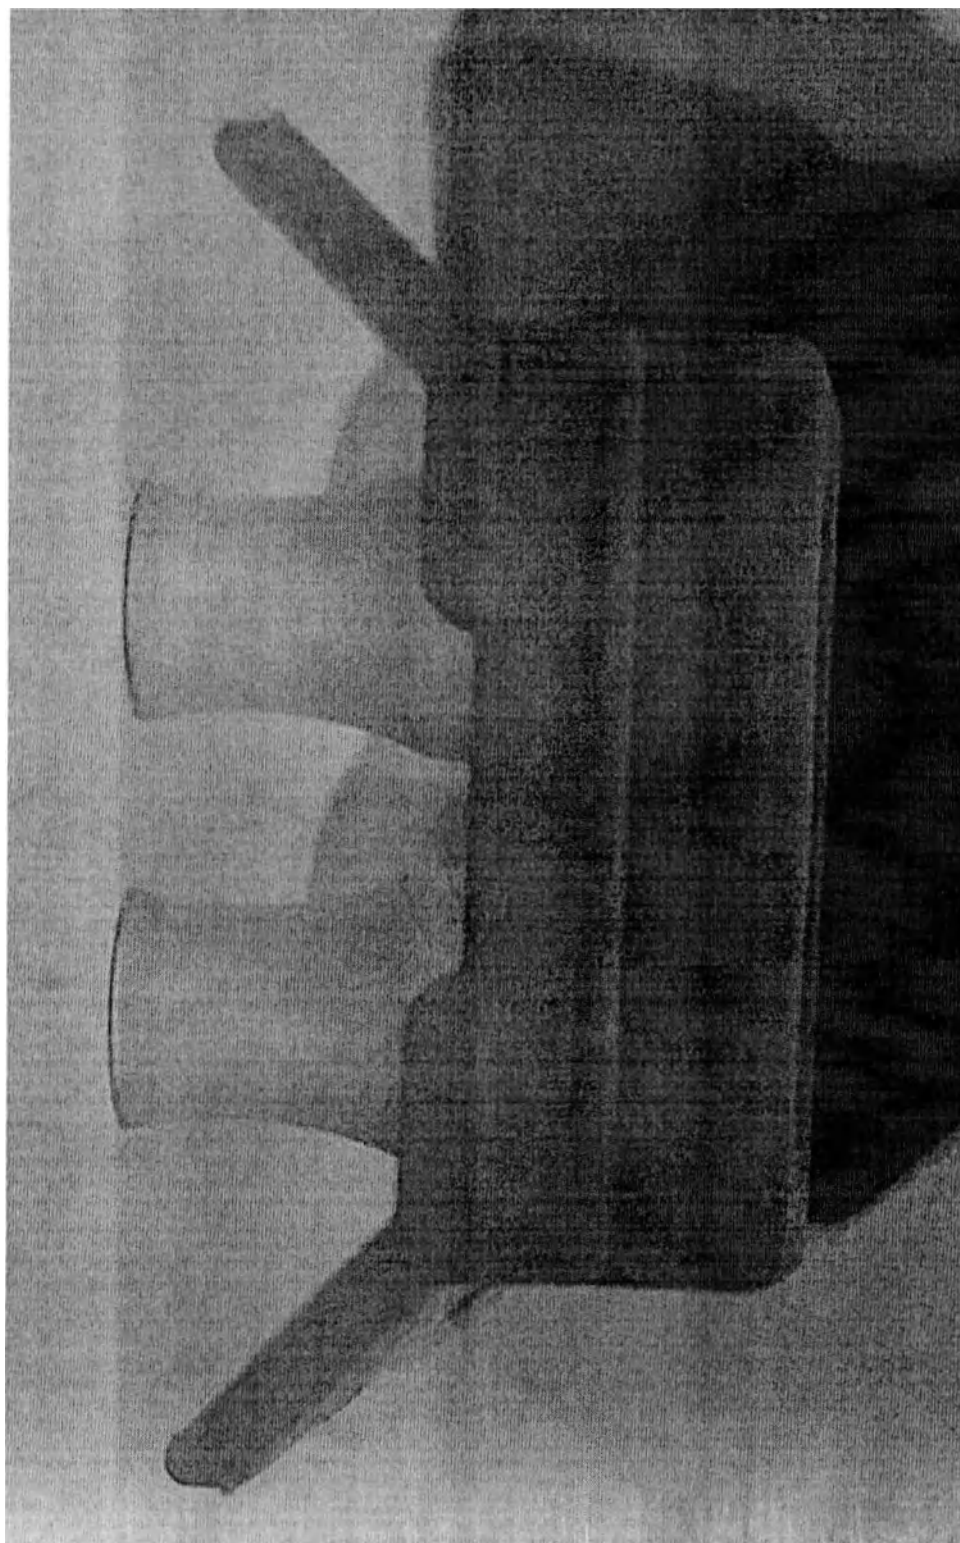


38.2 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: назальные канюли для новорожденных с прямыми зубцами; для назального СРАР, размер М (средний), 4702000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для «СРАР, ТЕСН.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




38.2 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: назальные канюли для новорожденных с прямыми зубцами; для назального СРАР, размер L (большой), 4703000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для «СРАР, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

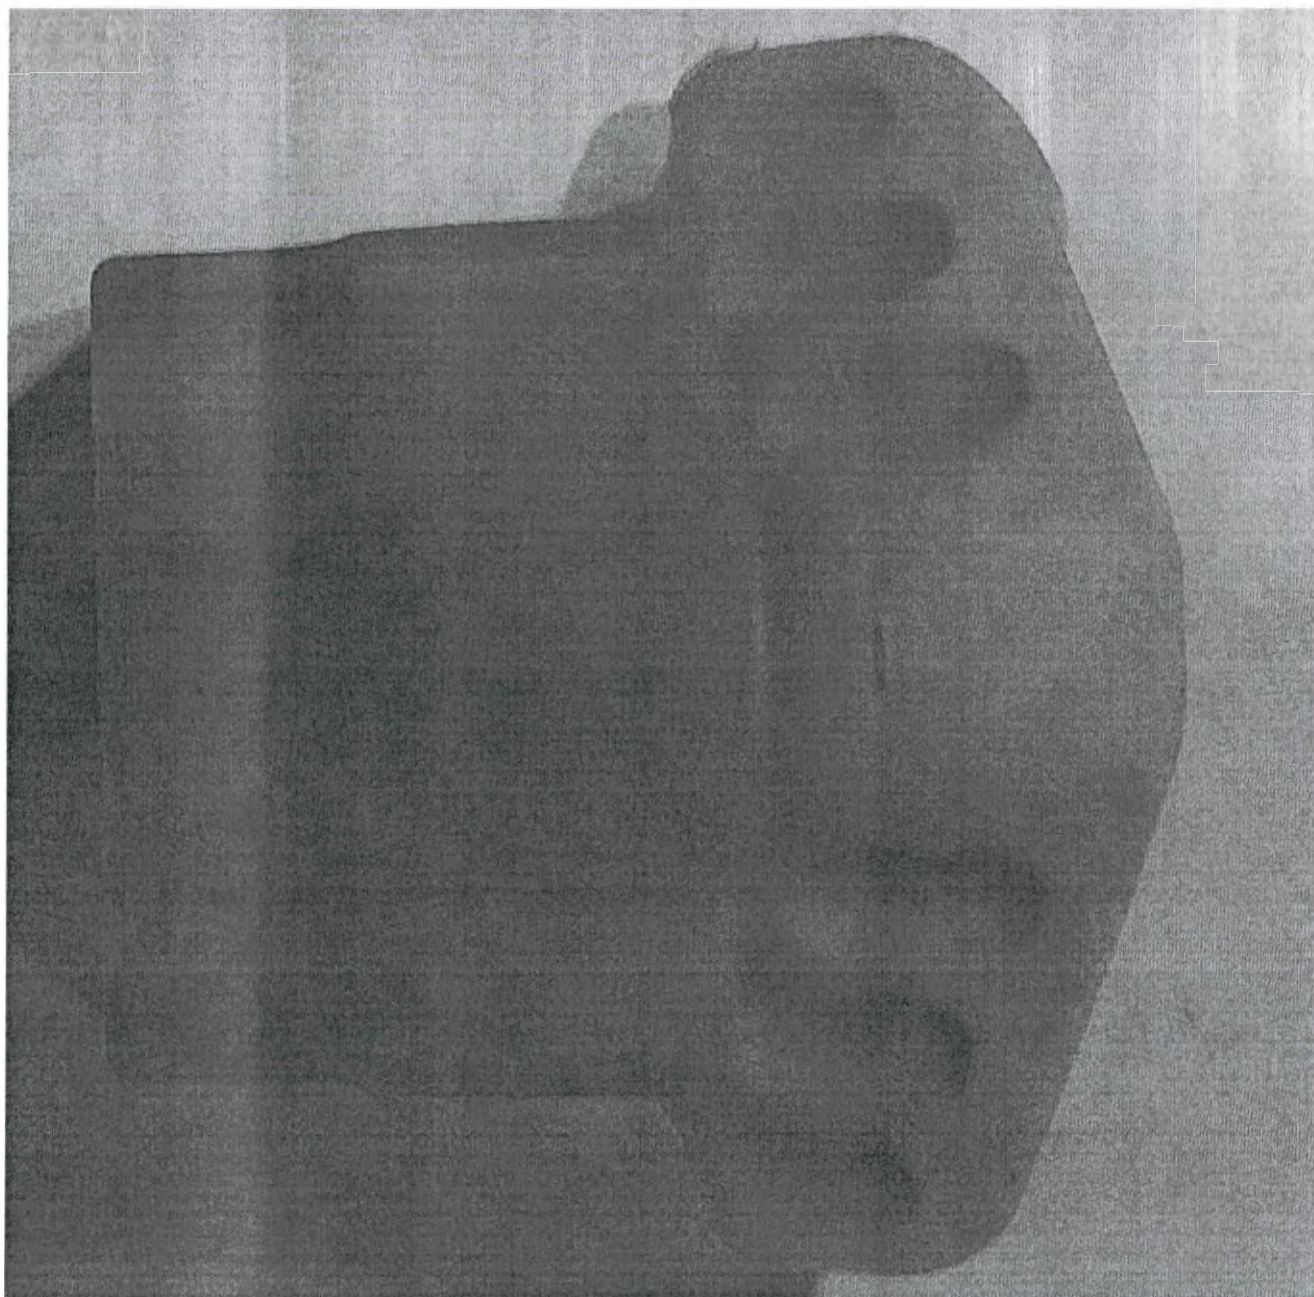


38.3 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для новорожденных, размер S (малый), 4704000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

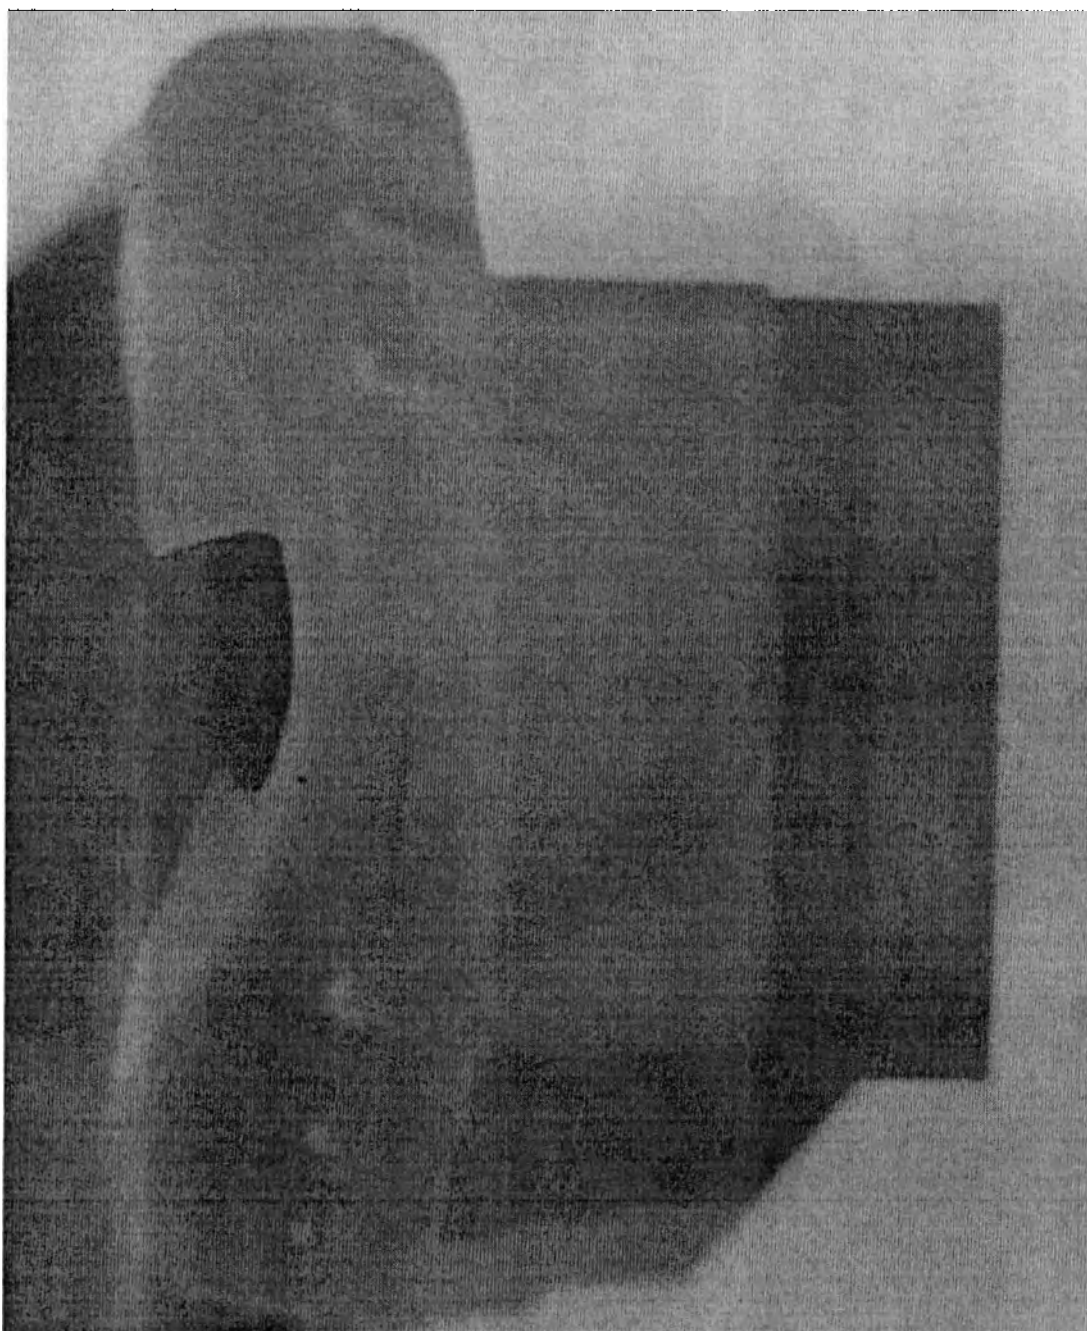


38.3 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для новорожденных, размер М (средний), 4705000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

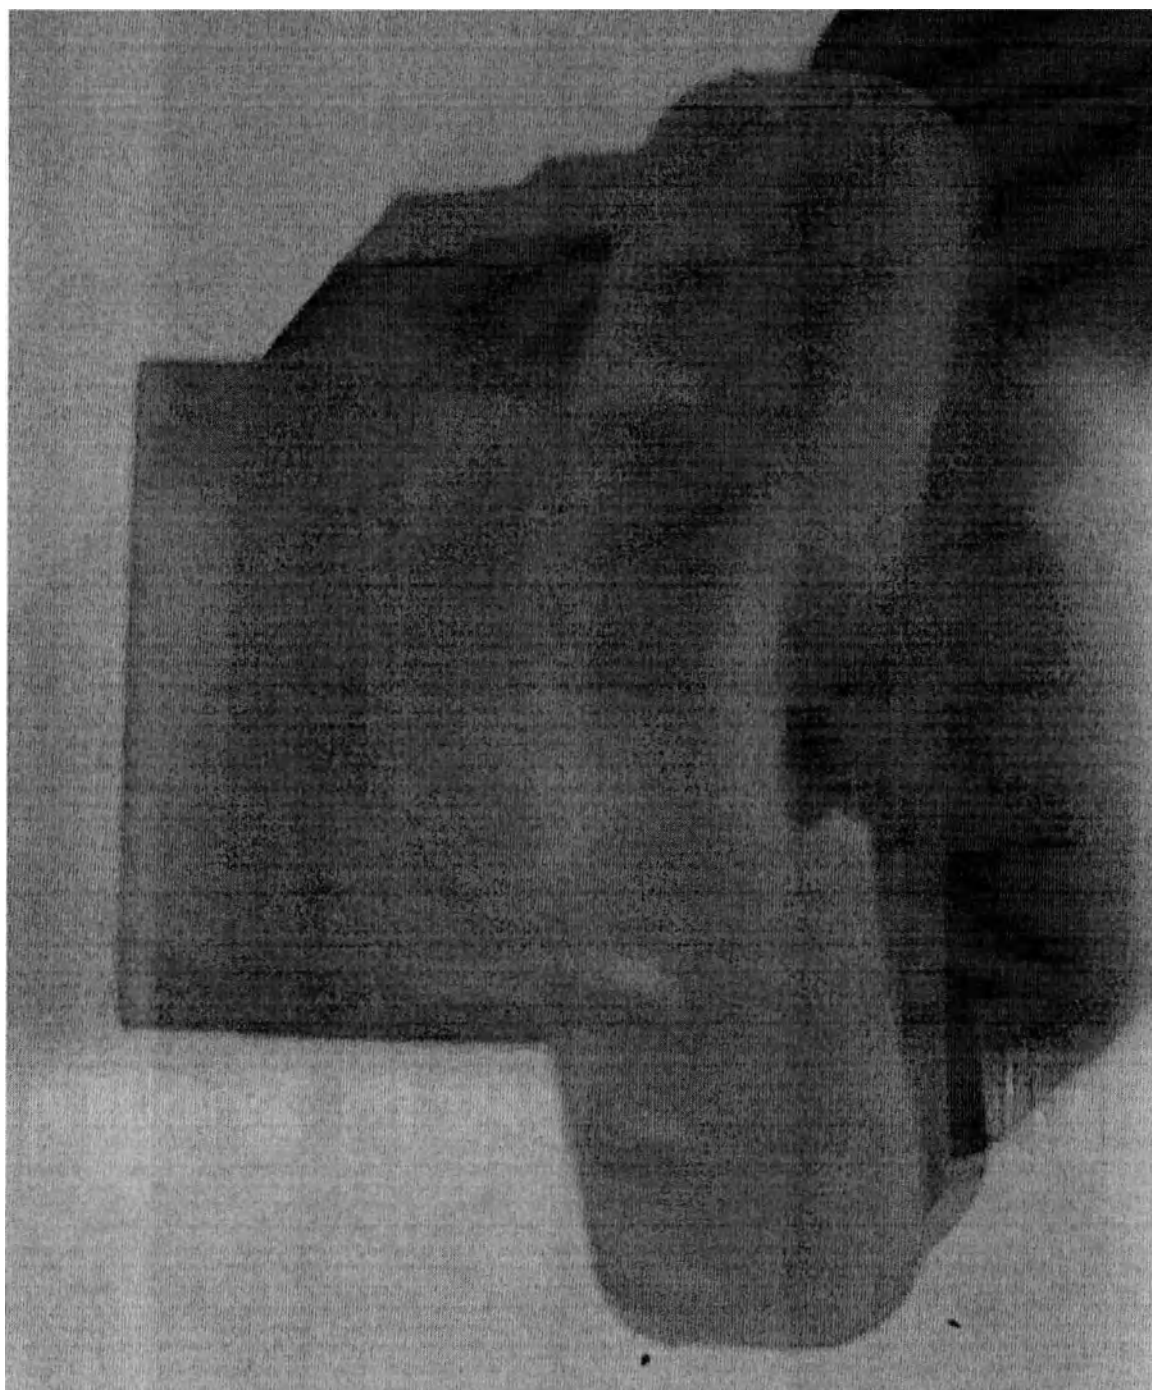


38.3 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для новорожденных, размер L (большой), 4706000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

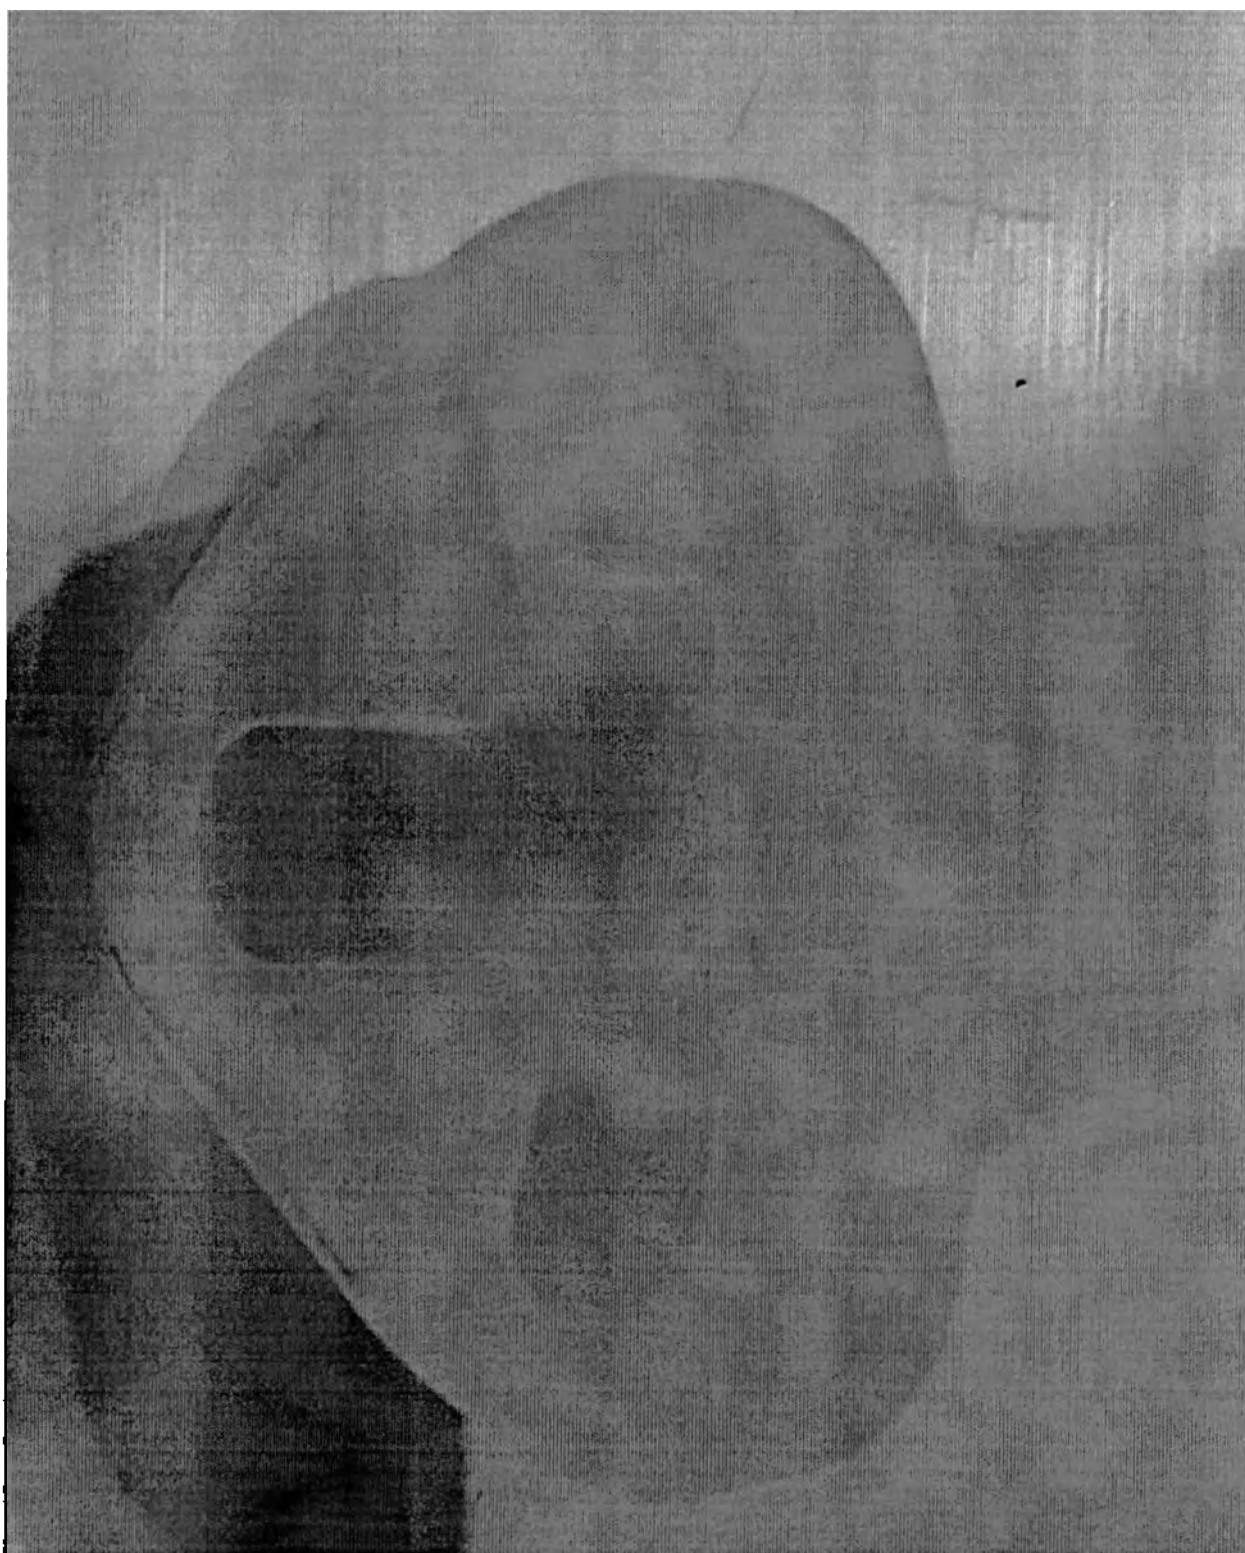


38.3 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции лёгких для новорожденных, размер XL (экстрабольшой), 4716000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

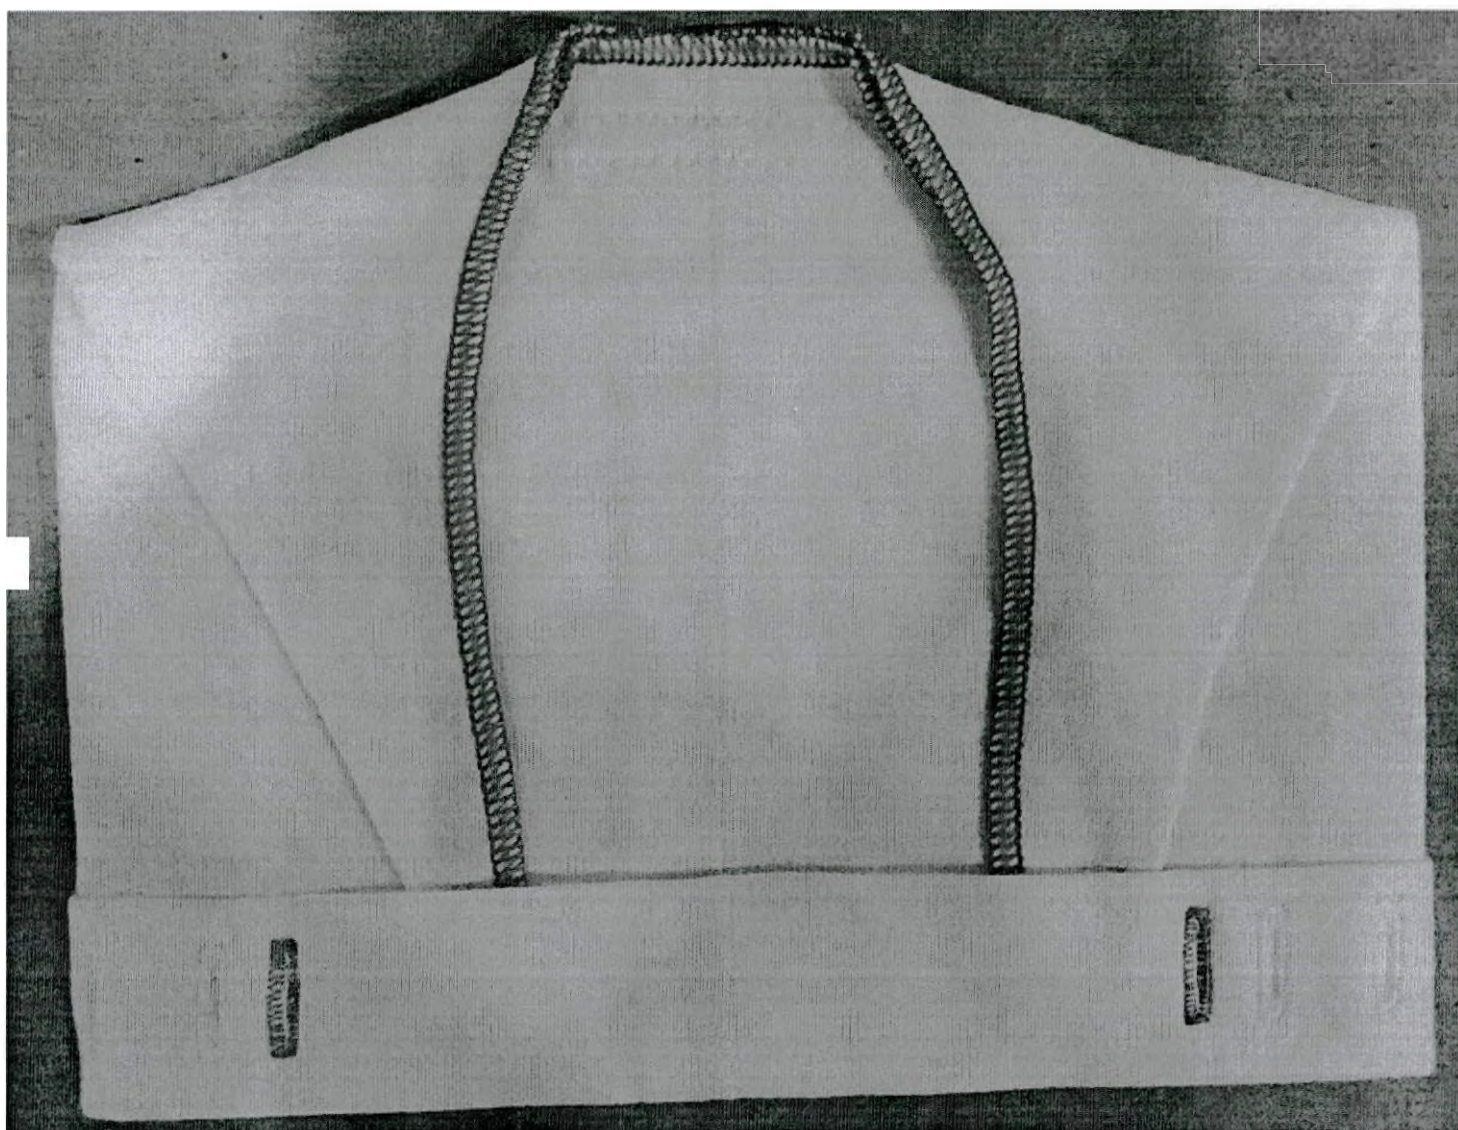


38.4 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: держатели-фиксаторы: для шлангов и трубок – шапочка, размер 7, 4707007, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

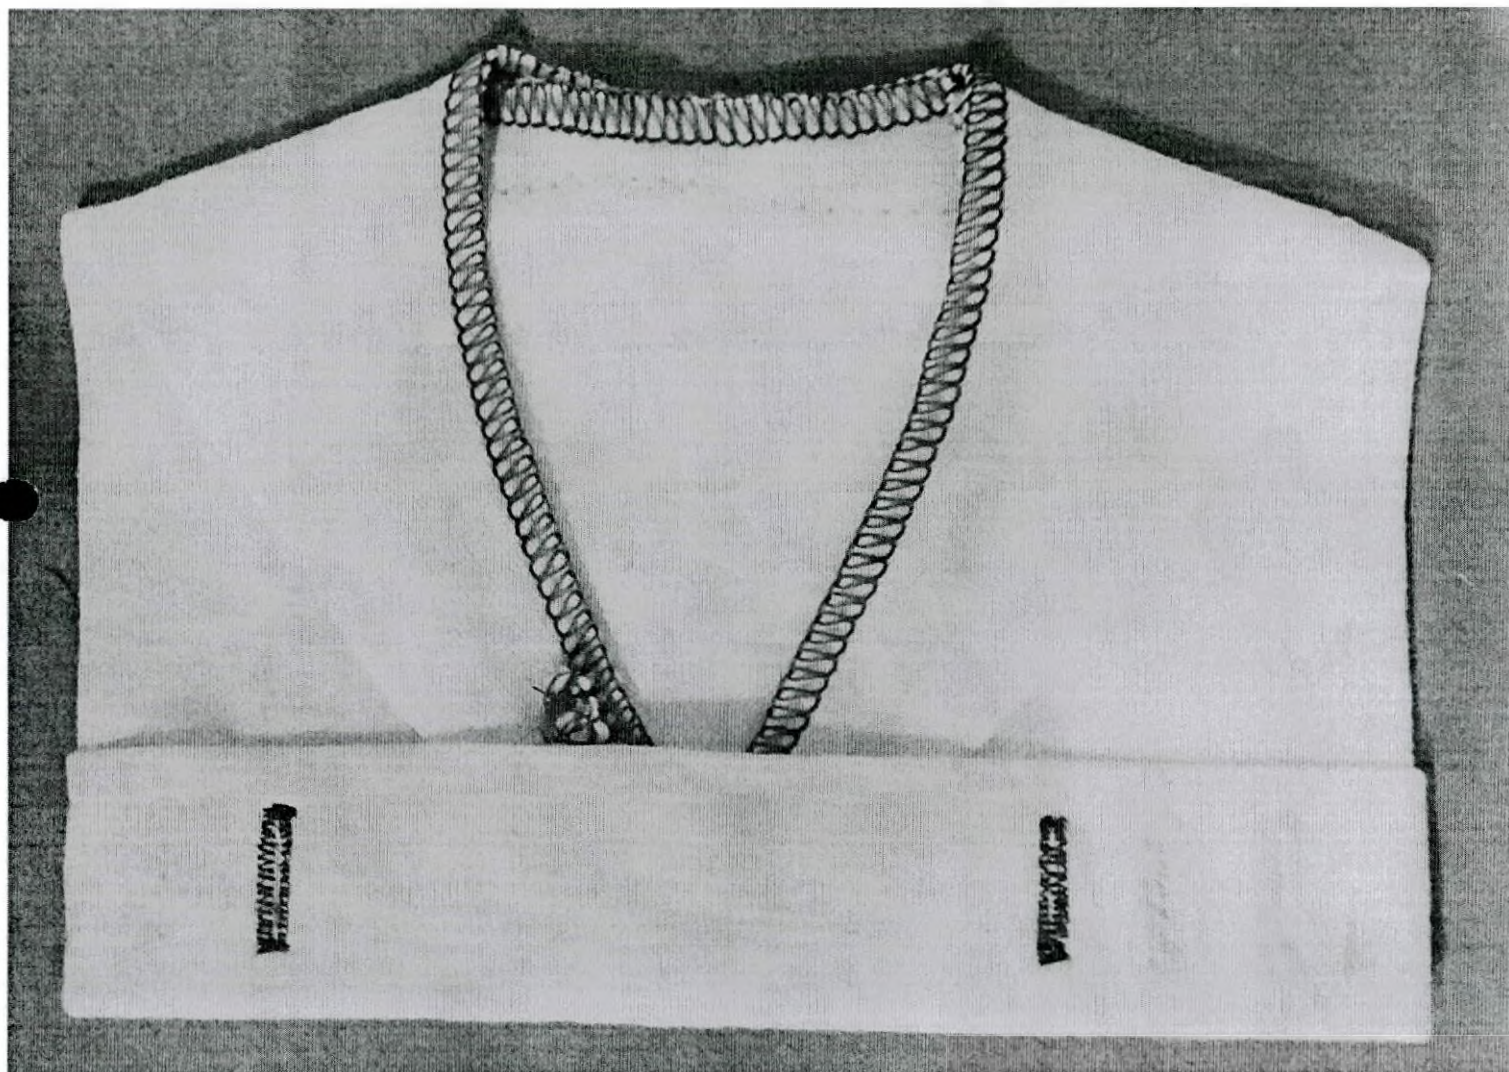


38.4 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: держатели-фиксаторы: для шлангов и трубок – шапочка, размер 3, 4707003, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

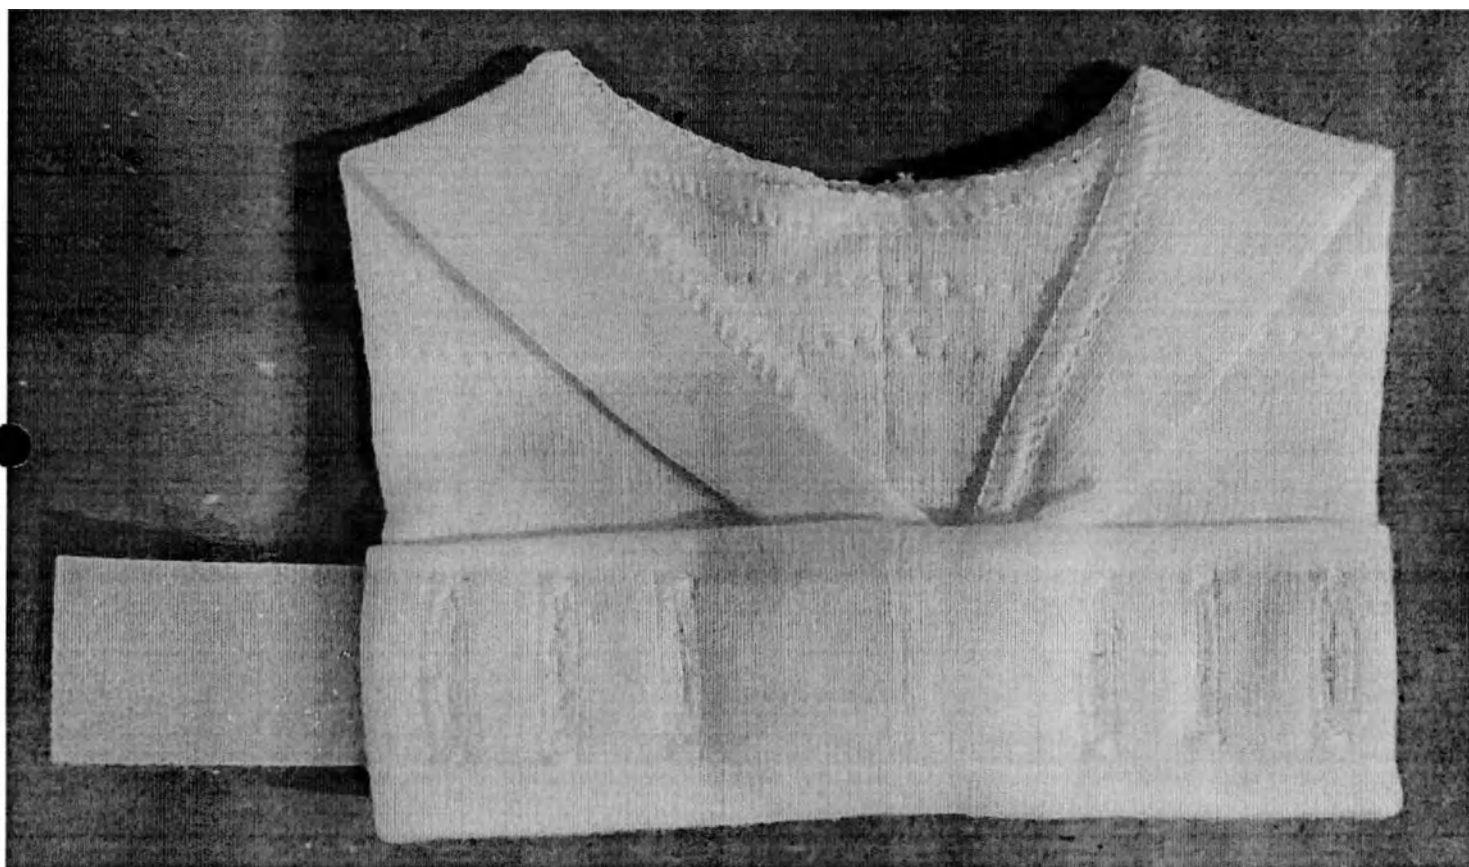

38.4 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: держатели-фиксаторы: для шлангов и трубок – шапочка, размер 000, 4707000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

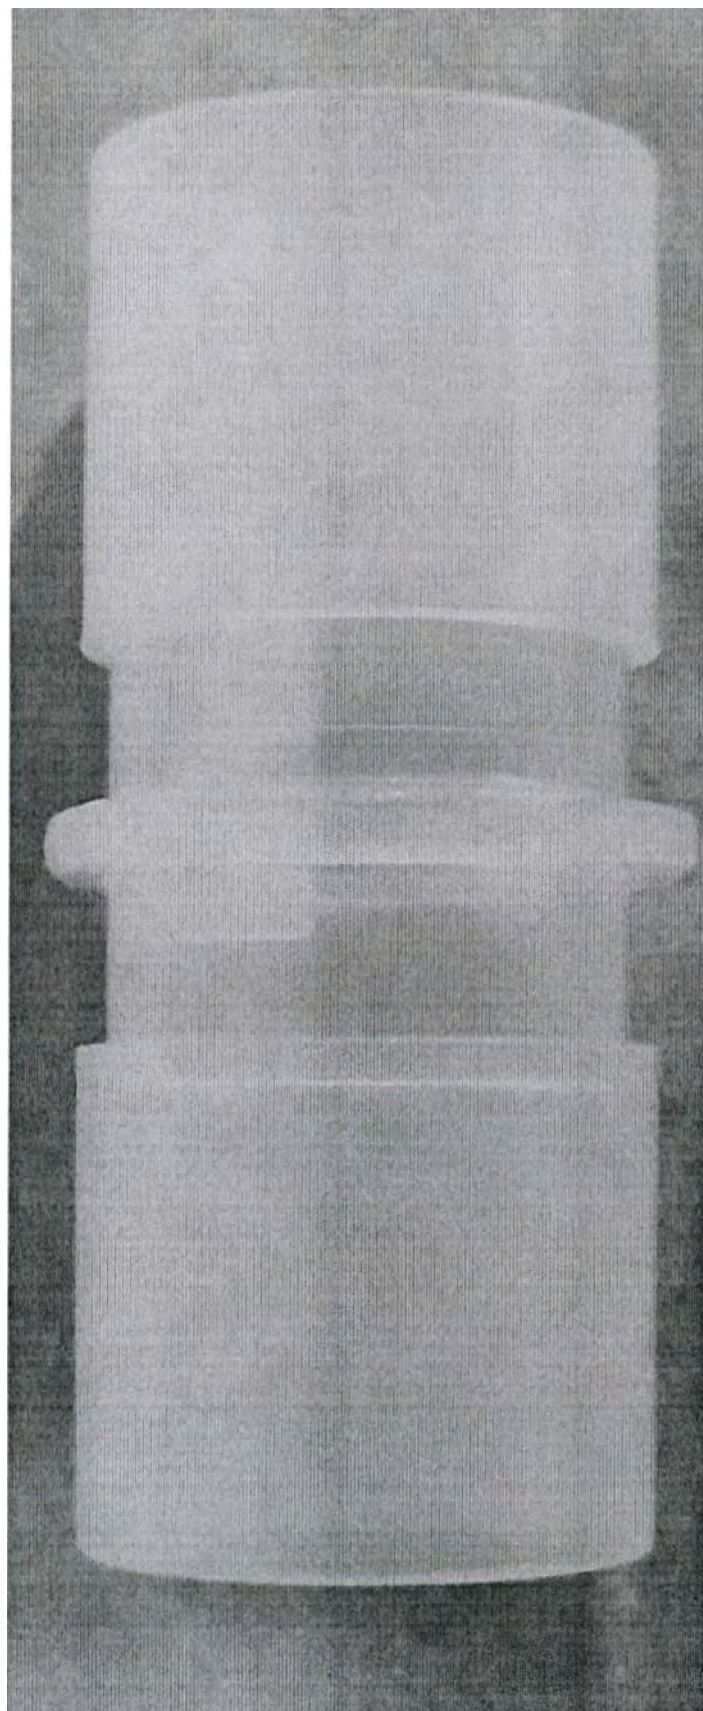


38.5 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель: жесткий; прямой, 1960000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd), в составе Набора для пCPAP, TECH.233014, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

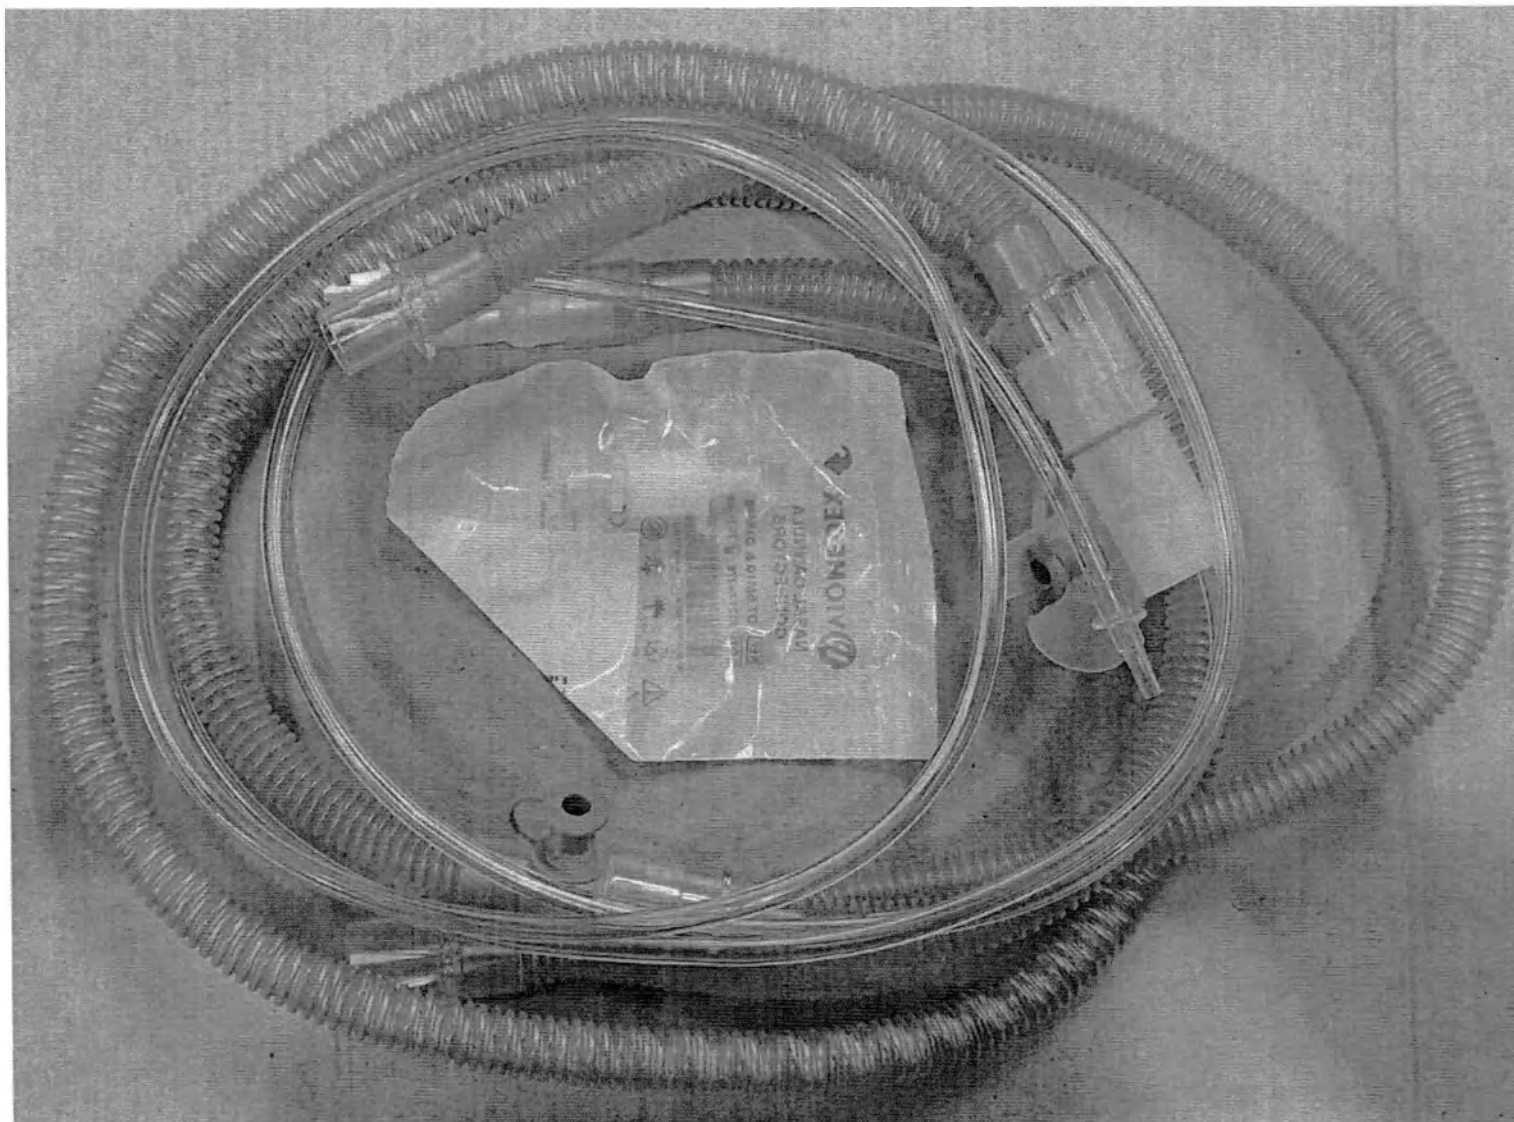


39.1 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: дыхательный контур пациента, вариант исполнения: дыхательный контур пациента с генератором дыхания, ИНС4064N, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для пСРАР, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




**39.2 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных:
канюли назальные, размер S, VX8021, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед»,
Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС», Россия**

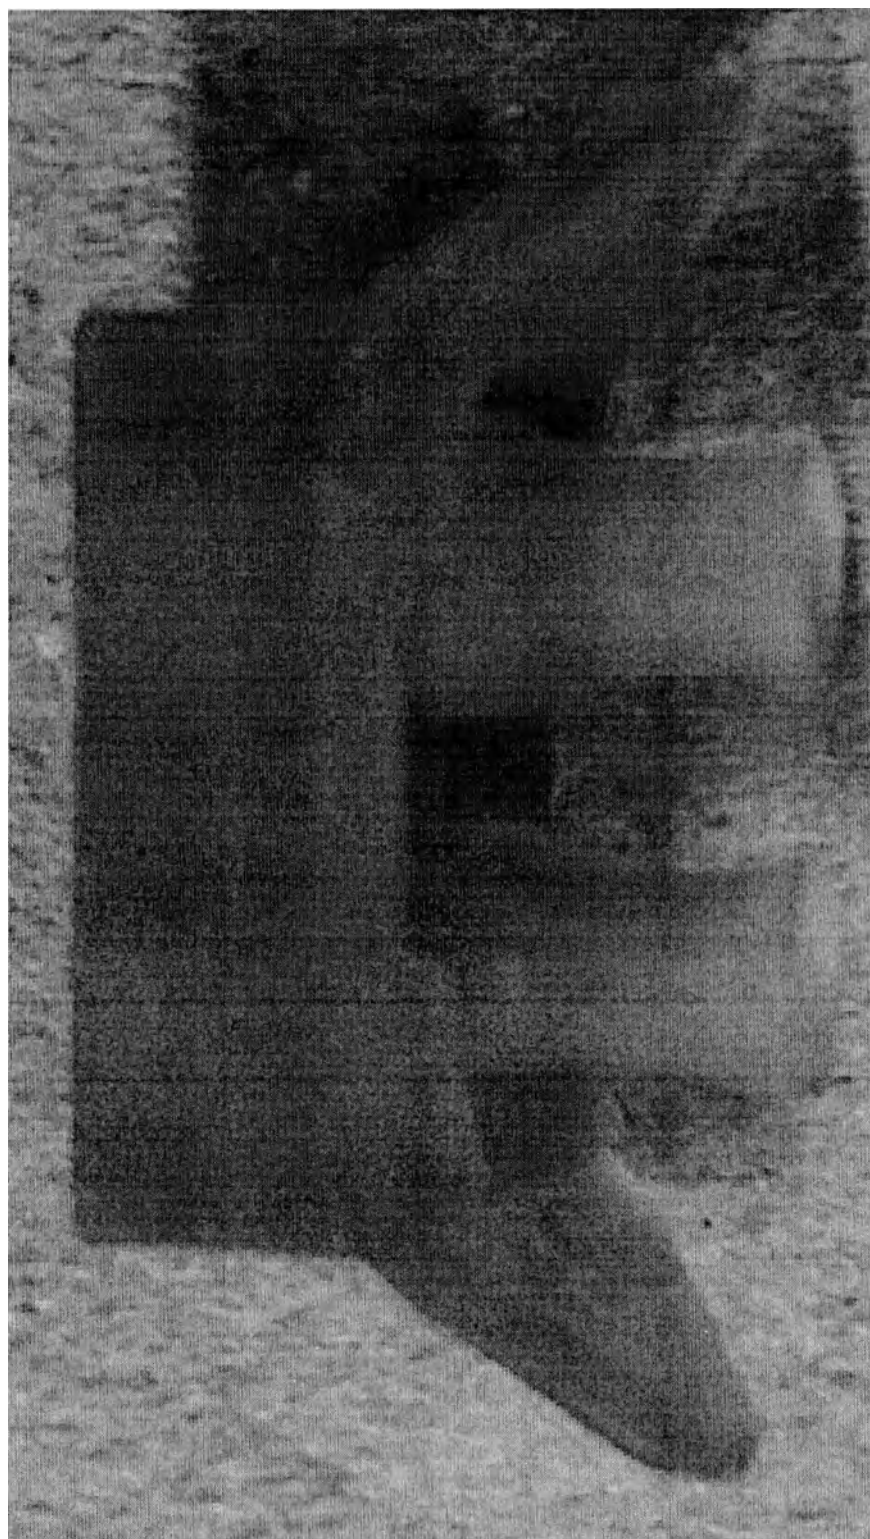


39.2 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных:
канюли назальные, размер M, VX8022, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед»,
Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для пCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС», Россия

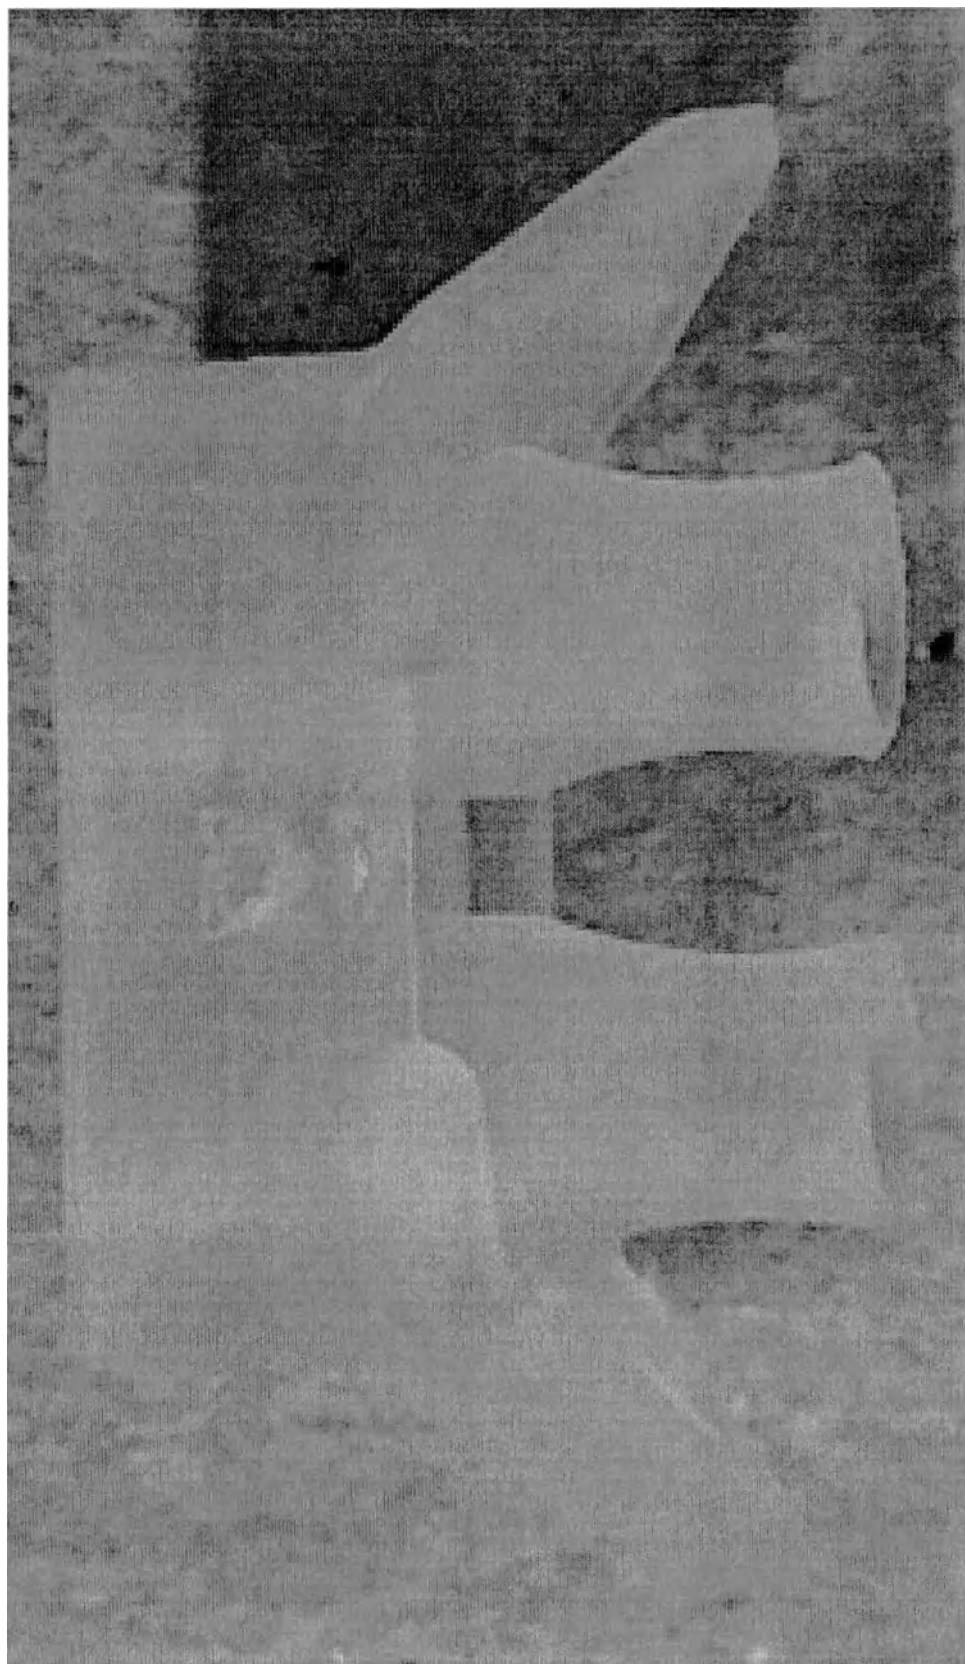


39.2 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: канюли назальные, размер L, VX8023, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

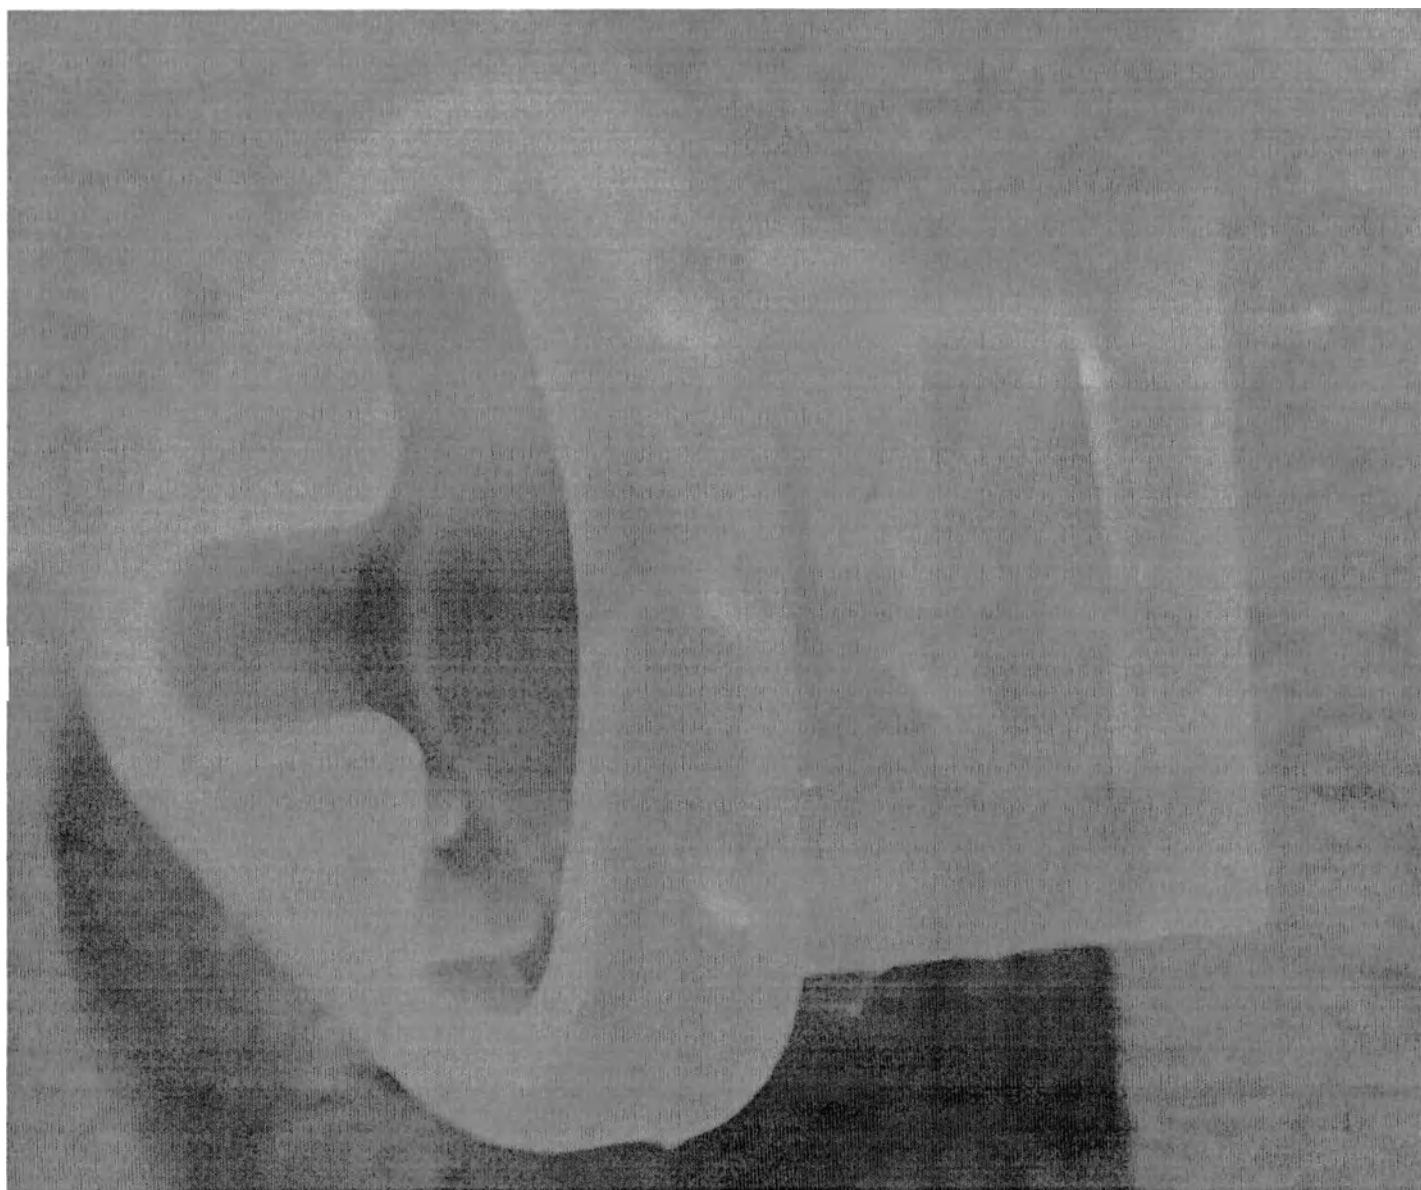


39.3 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: маски лицевые дыхательные, размер S, VX8030, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

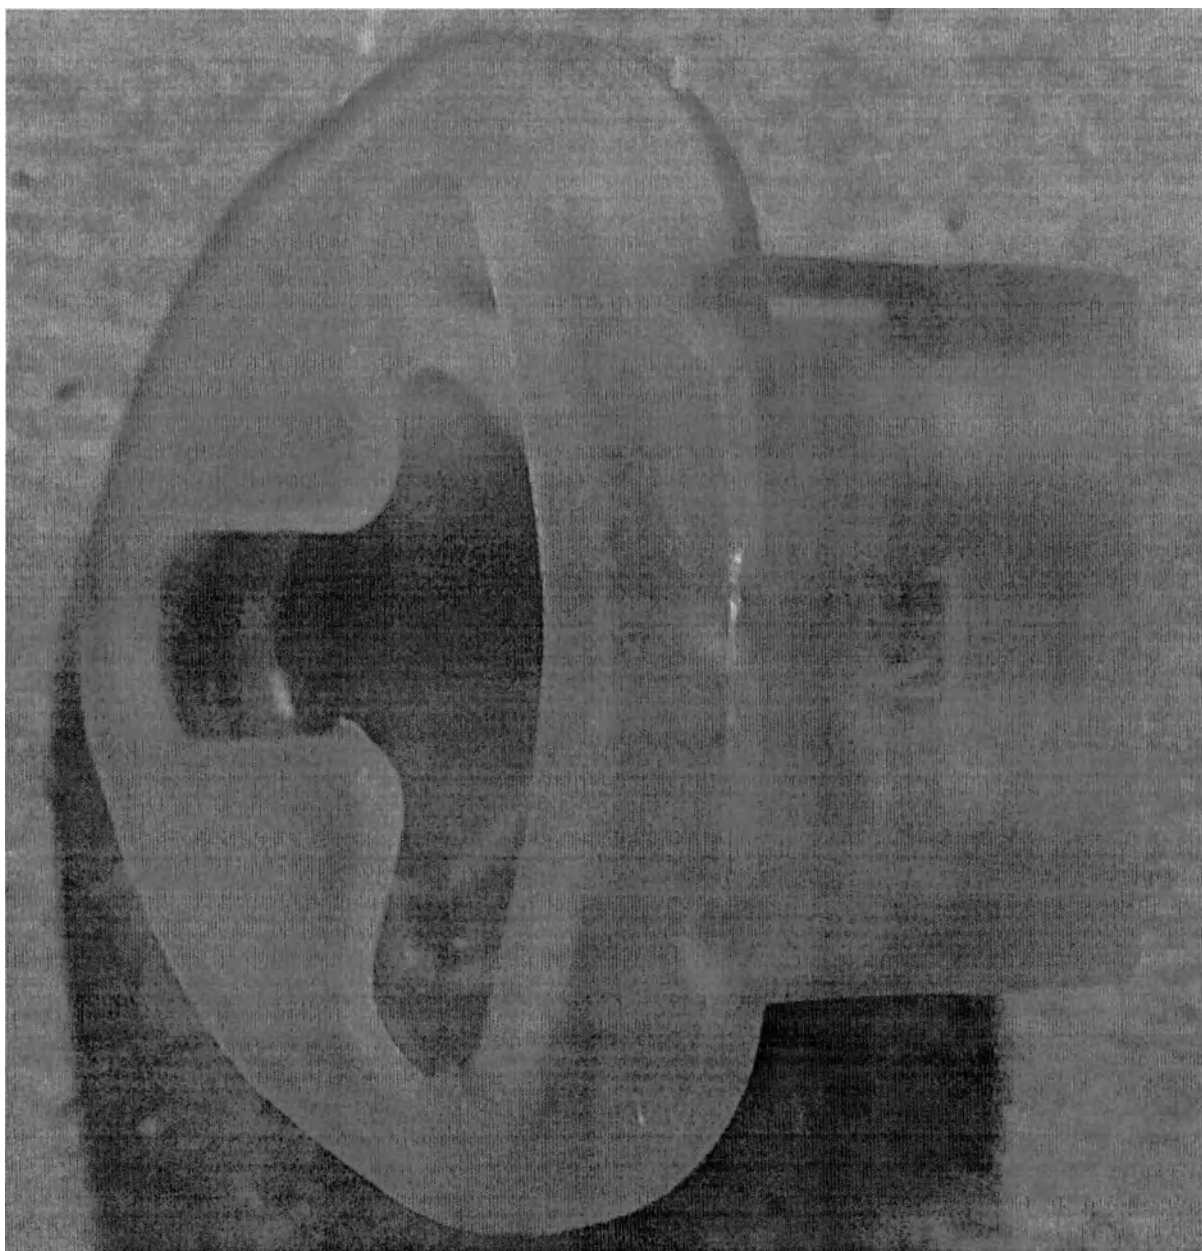


39.3 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: маски лицевые дыхательные, размер М, VX8031, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для пCPAP, ТЕСН.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

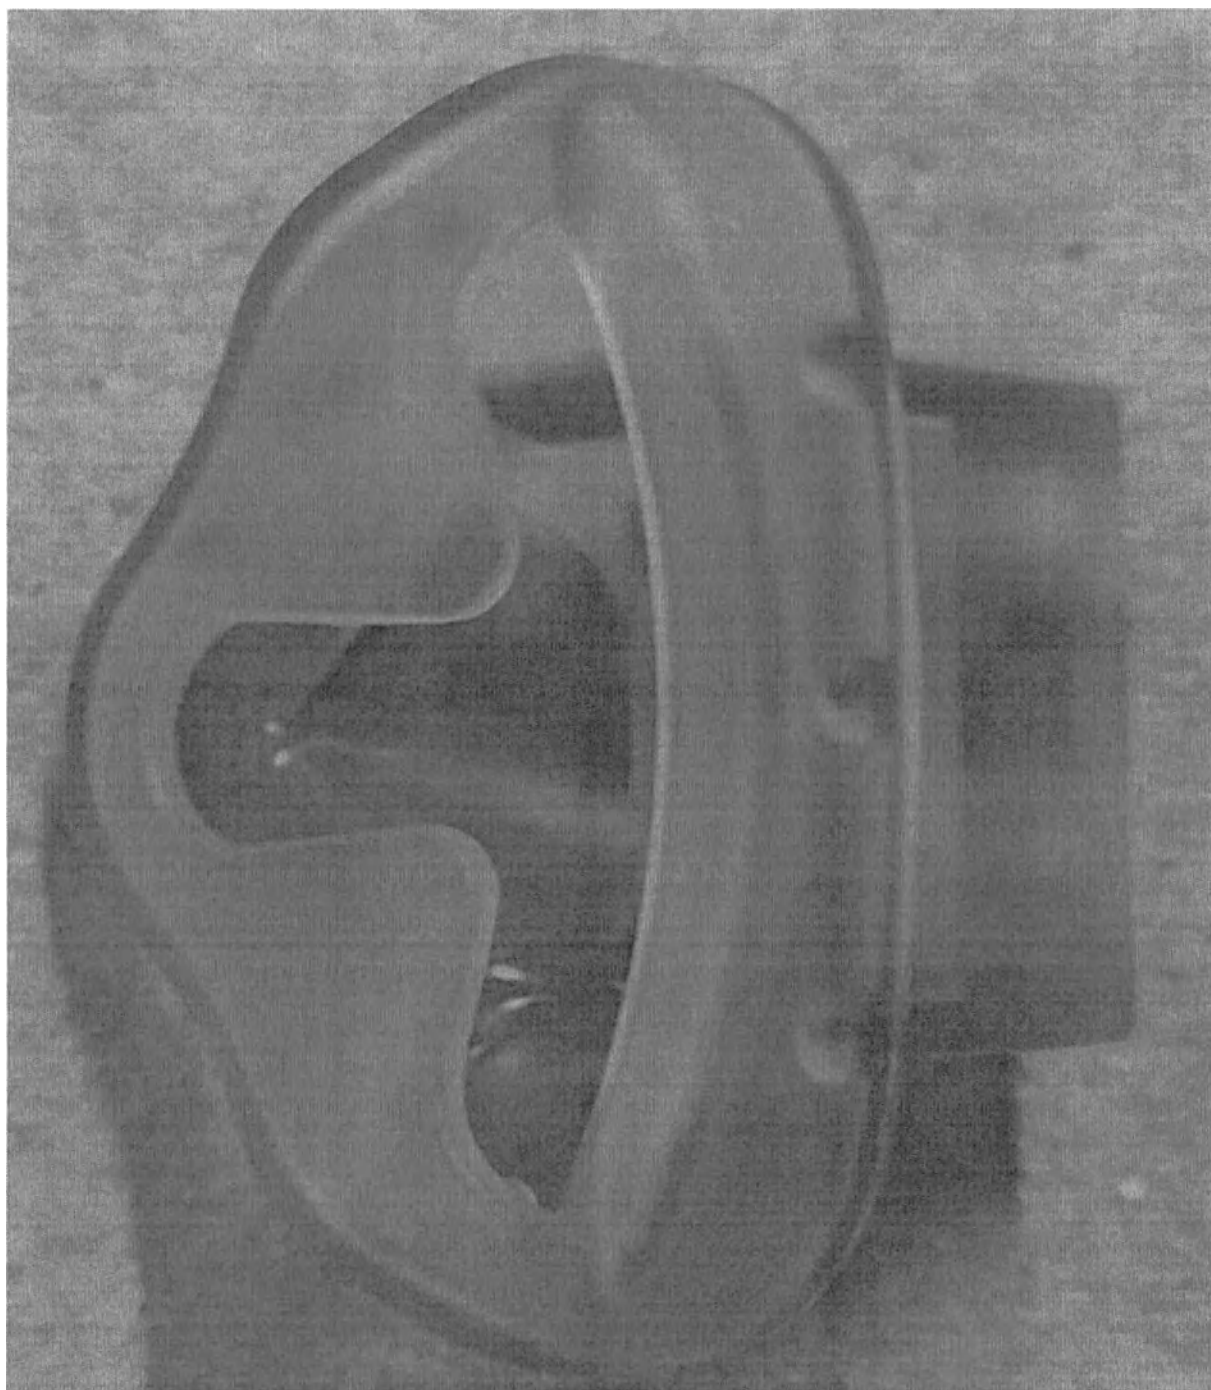


39.3 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: маски лицевые дыхательные, размер L, VX8032, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

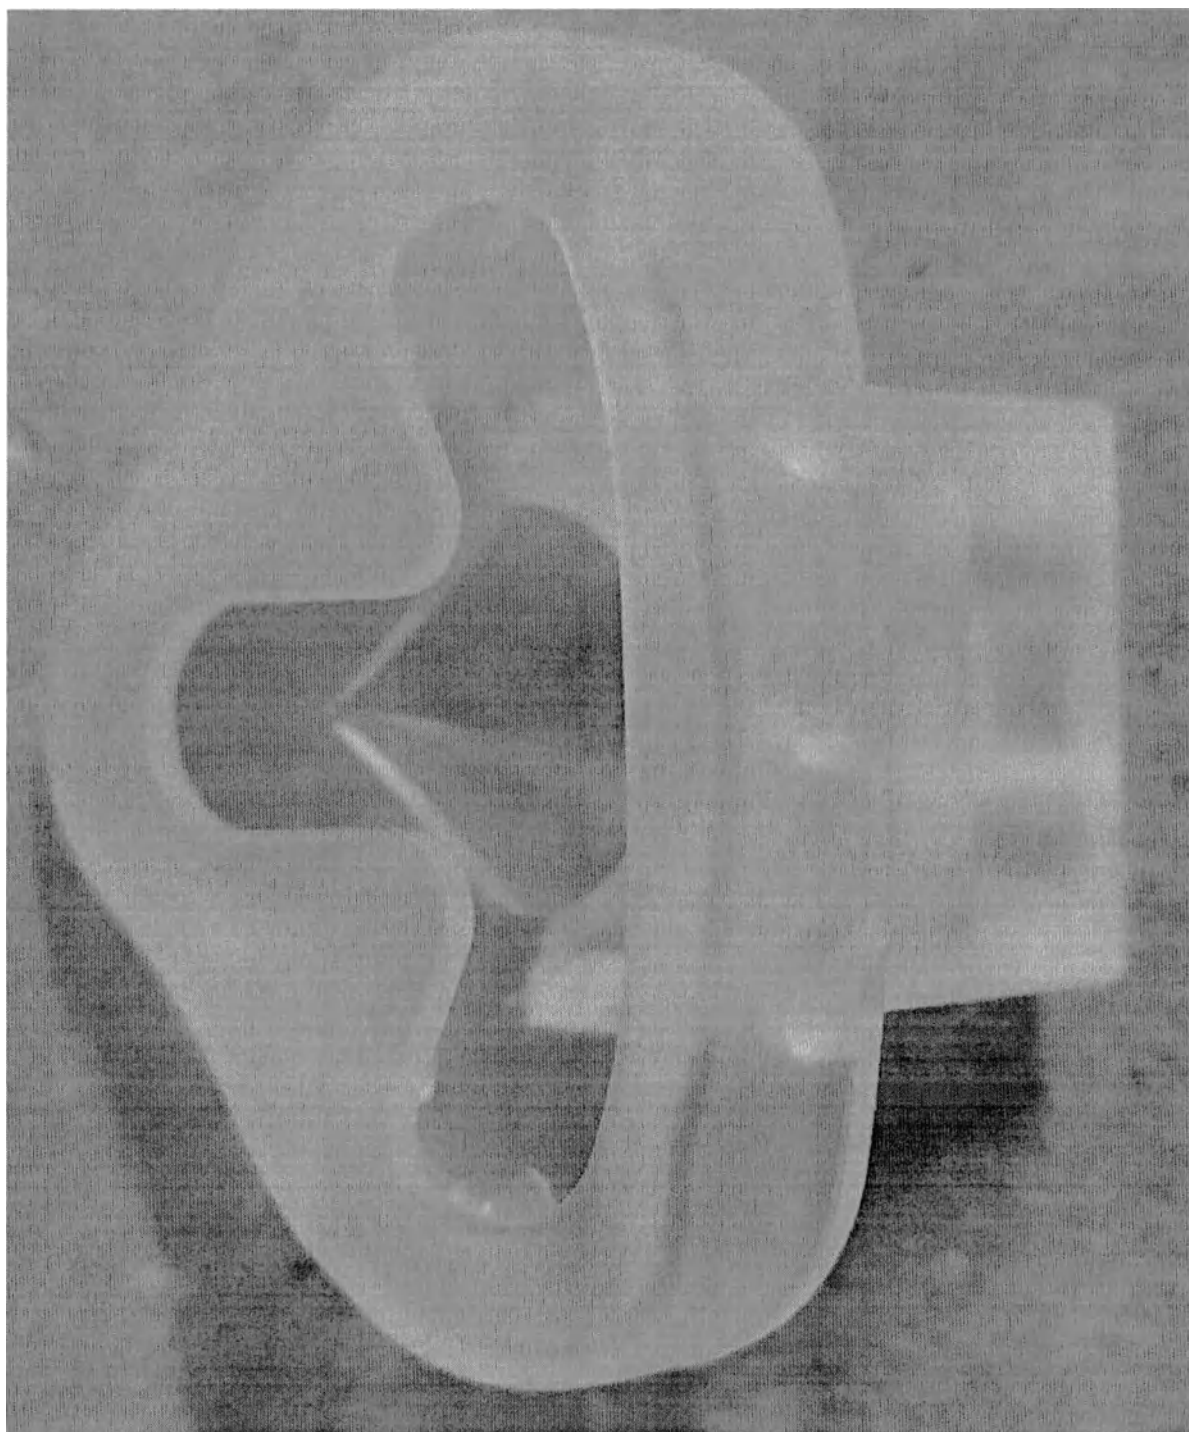


39.3 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: маски лицевые дыхательные, размер XL, VX8033, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

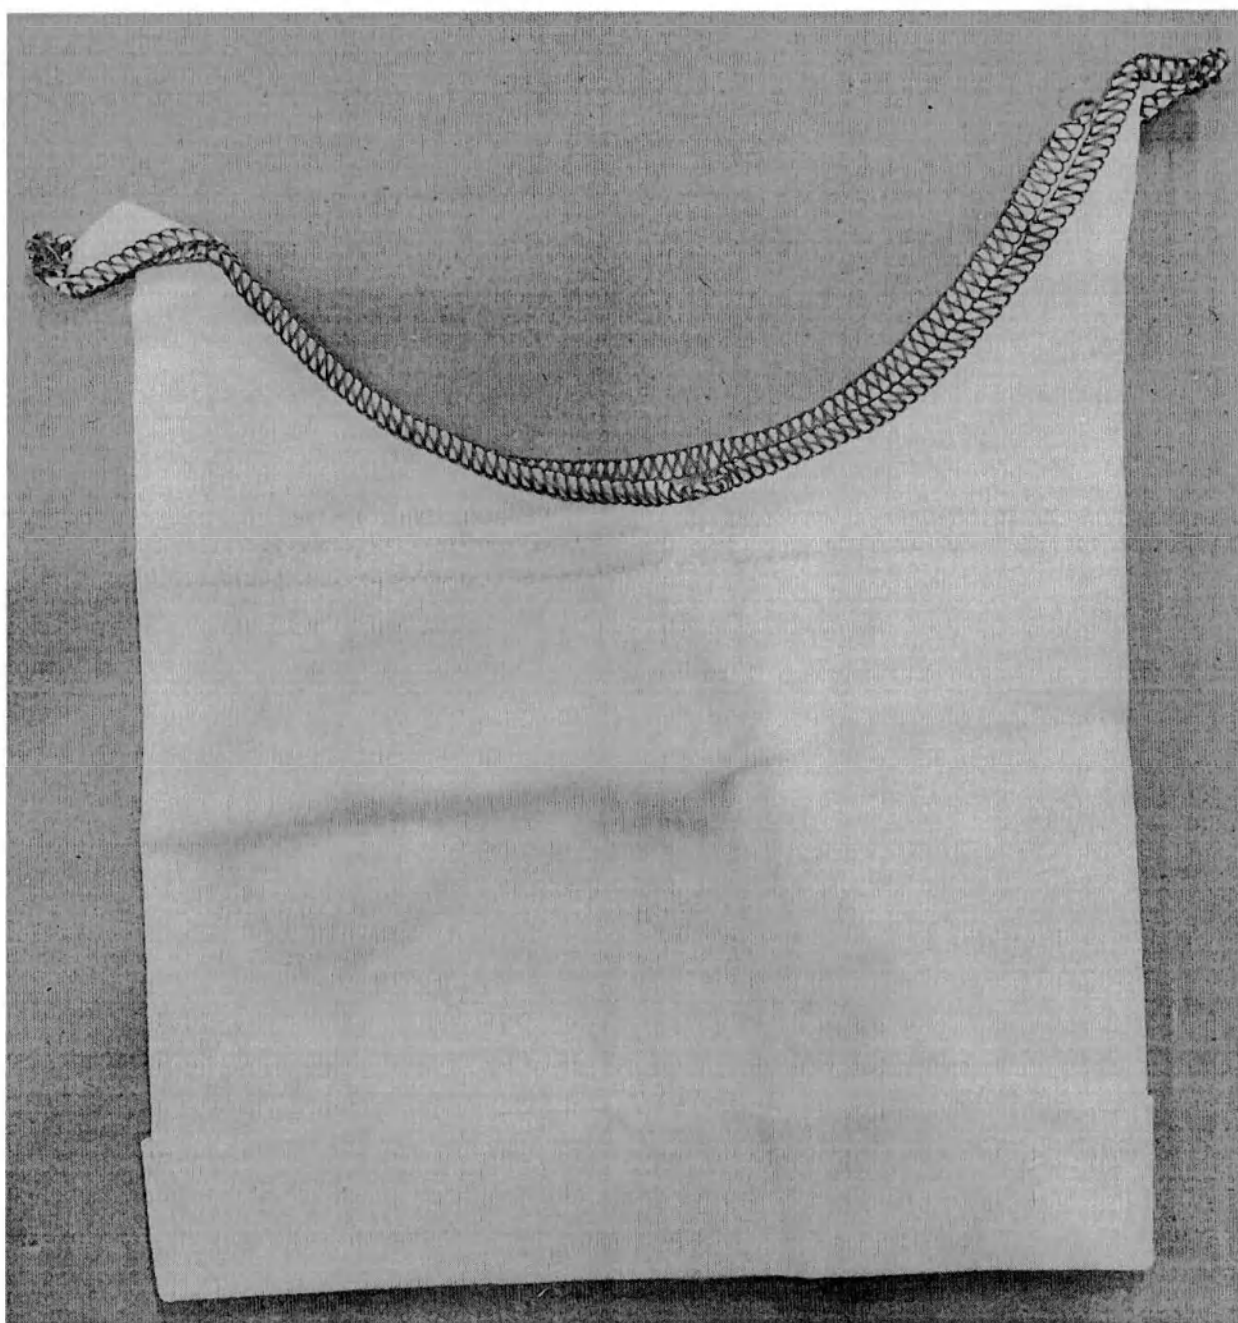


39.4 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: шапочки-фиксаторы дыхательные: размер 8, INBDG8, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

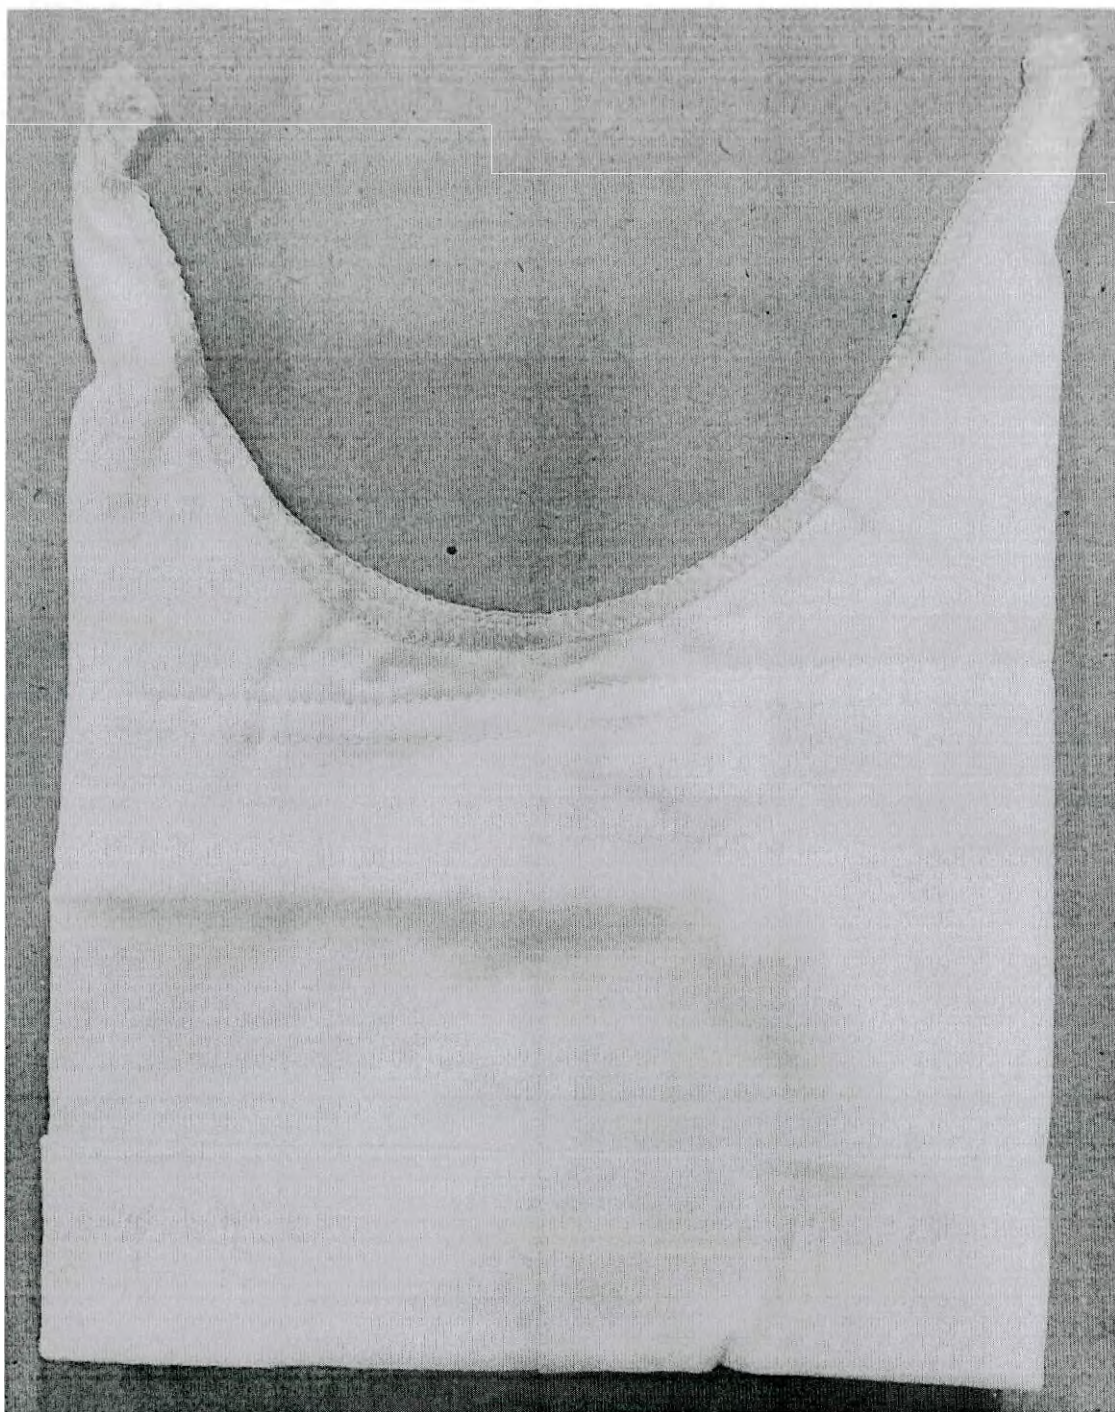


39.4 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: шапочки-фиксаторы дыхательные: размер 4, INBGO4, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

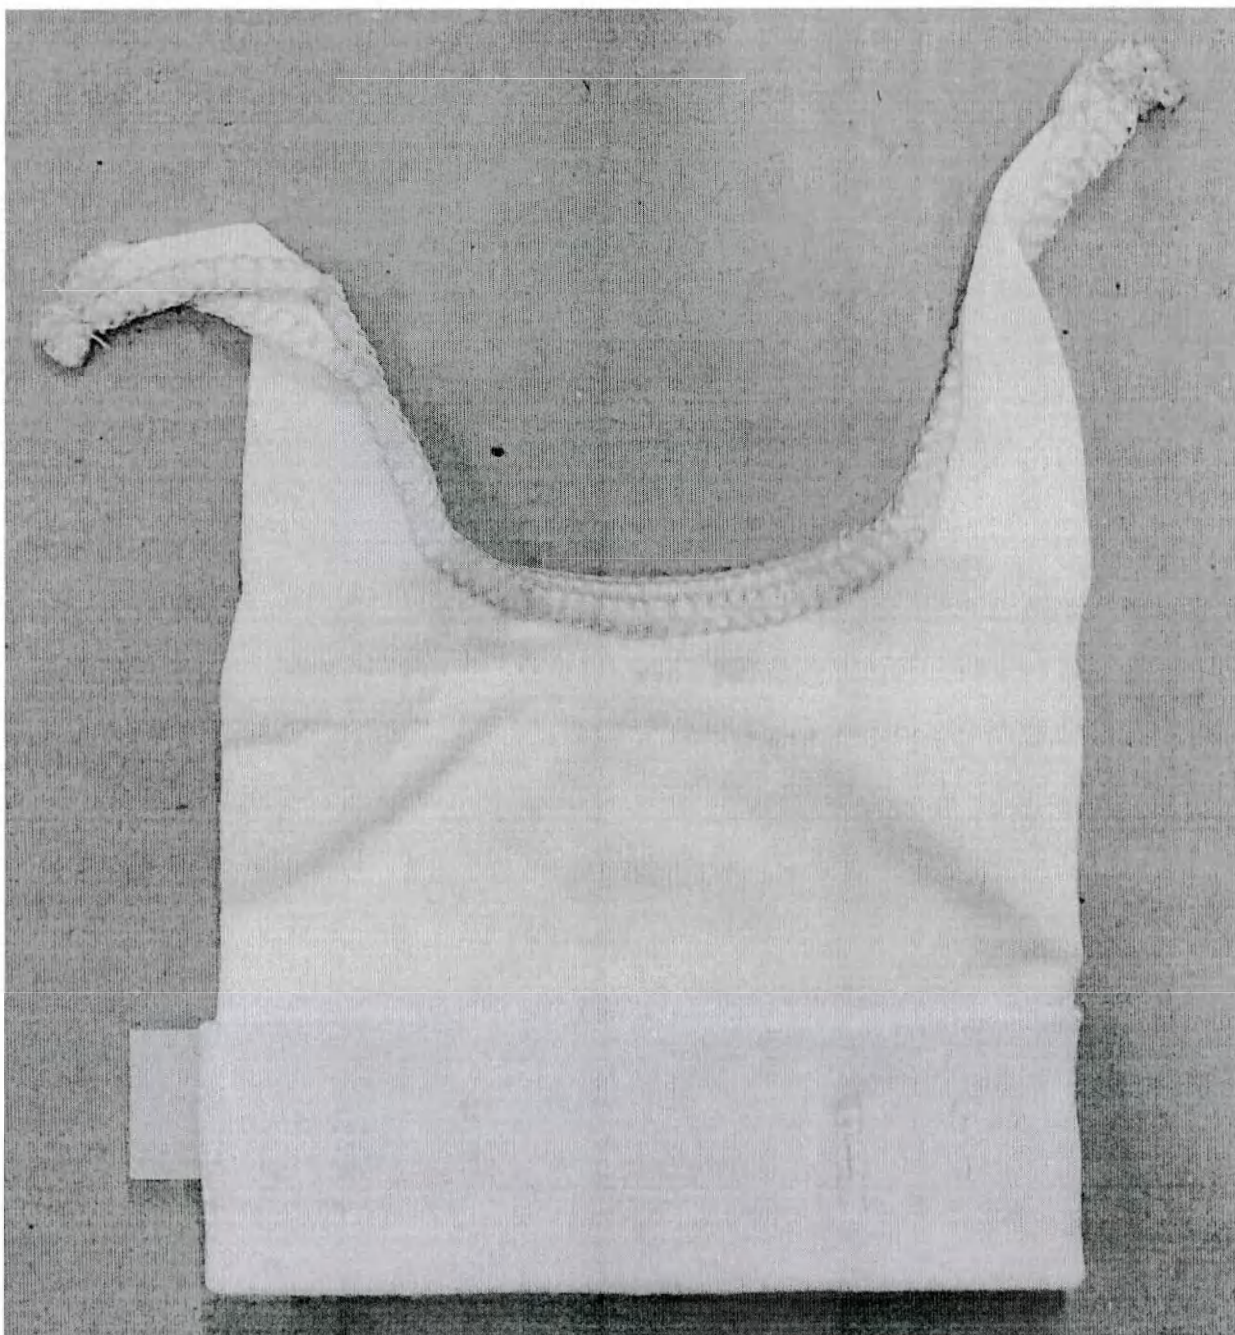

39.4 Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных: шапочки-фиксаторы дыхательные: размер 00, INBGY00, РУ № ФСЗ 2011/10229, «Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед», Великобритания (Inspiration Healthcare Limited), в составе Набора для nCPAP, TECH.233014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

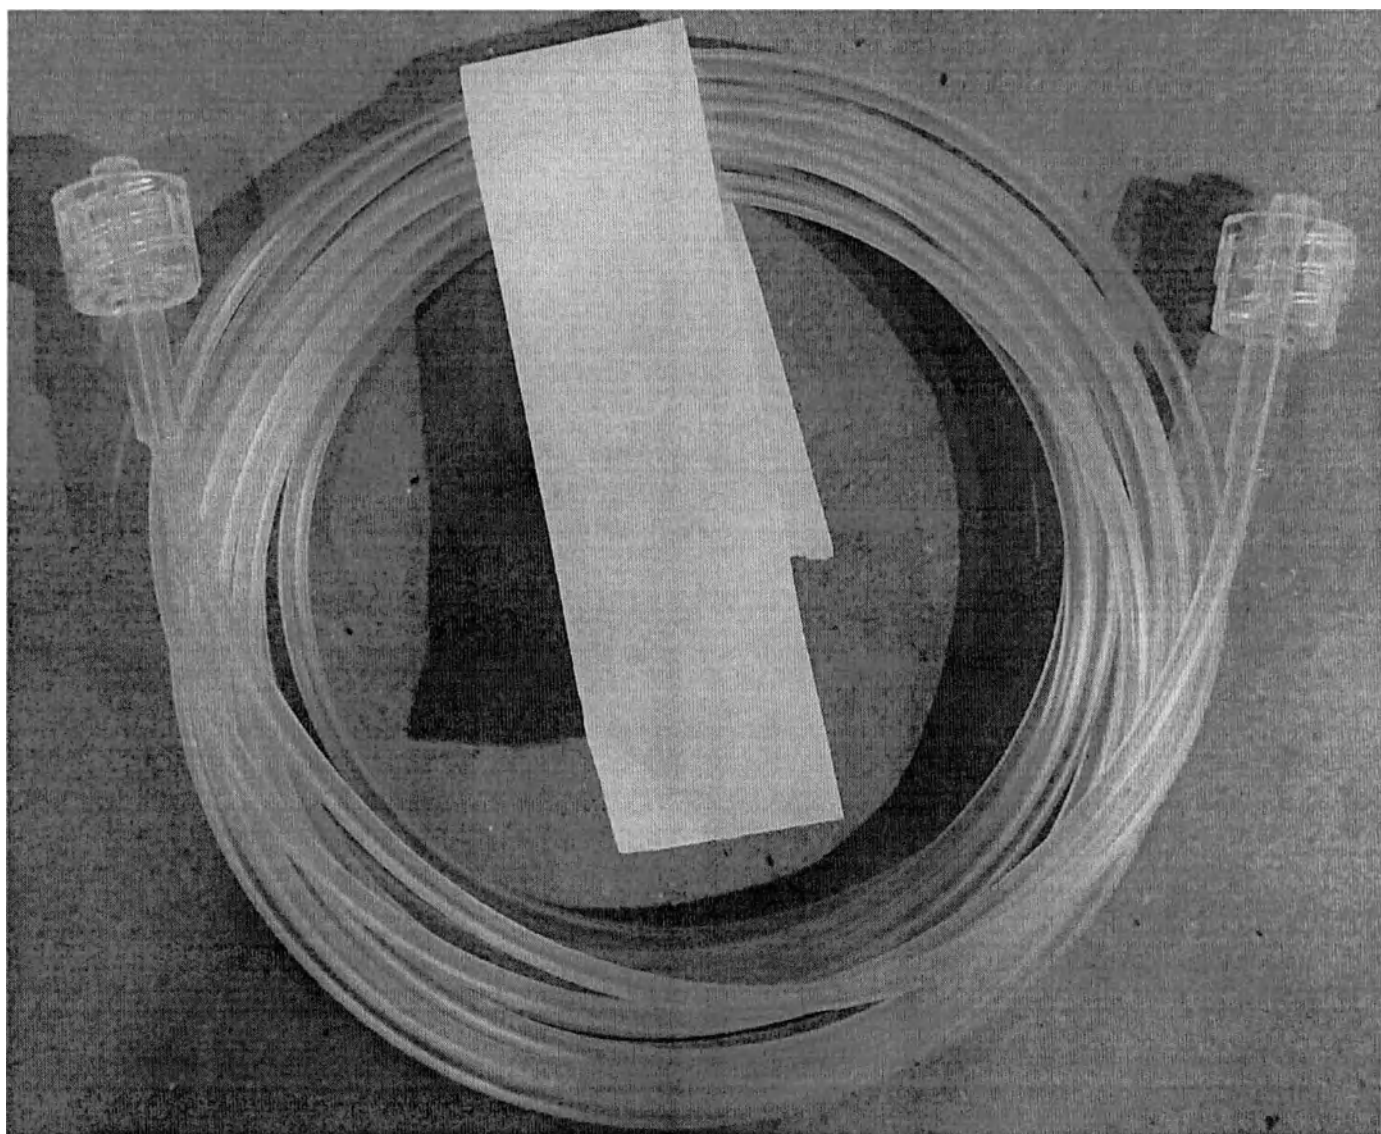

**40 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии:
линия мониторинга: линии мониторинга содержания углекислого газа, 2732000, РУ № ФСЗ 2009/03551,
«Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd.)**

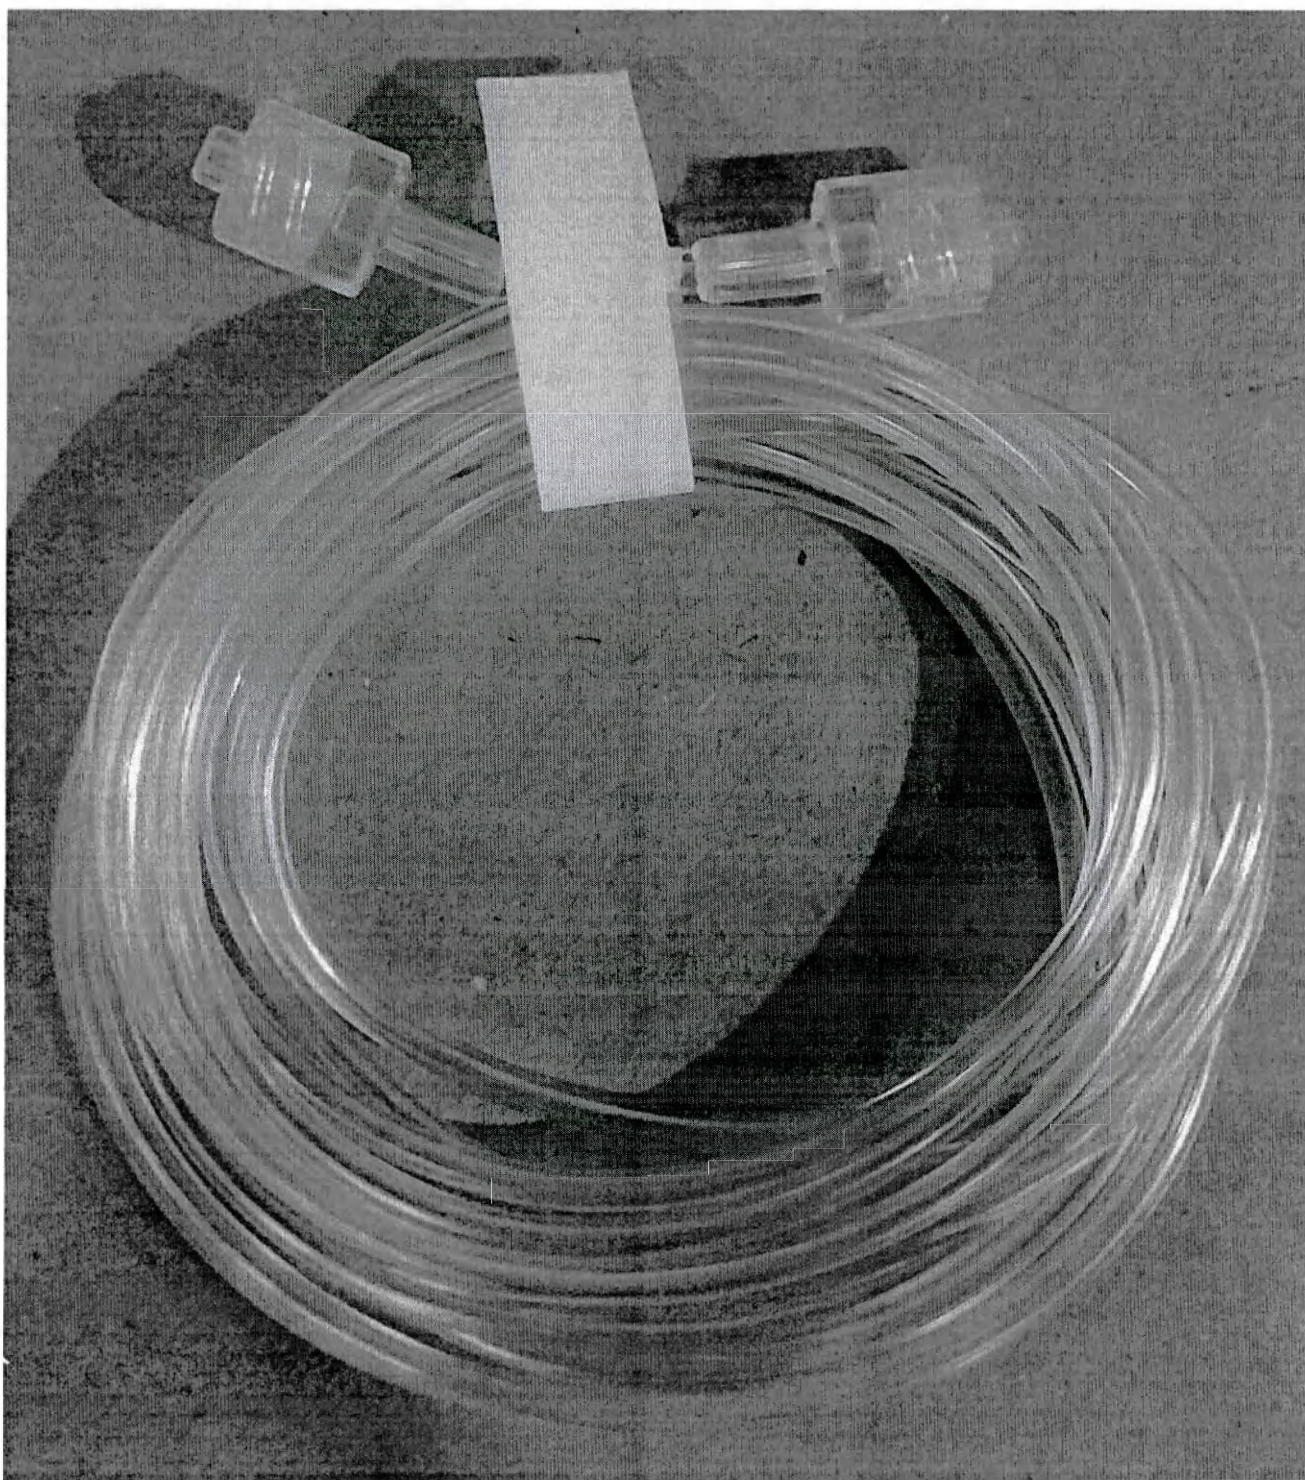

40 Линия отбора пробы газа, взрослая/детская, 010-700, Flexicare Medical Limited, Великобритания




41 Влагодотделитель взрослый/детский, DRYLINE™ Water Trap, Adult, 60-13100-00, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., KHP




42 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии:
соединитель с портами, без линий мониторинга: жесткий; угловой, 2714000, РУ № ФСЗ 2009/03551,
«Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd.)


43 Модуль газоанализатора дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

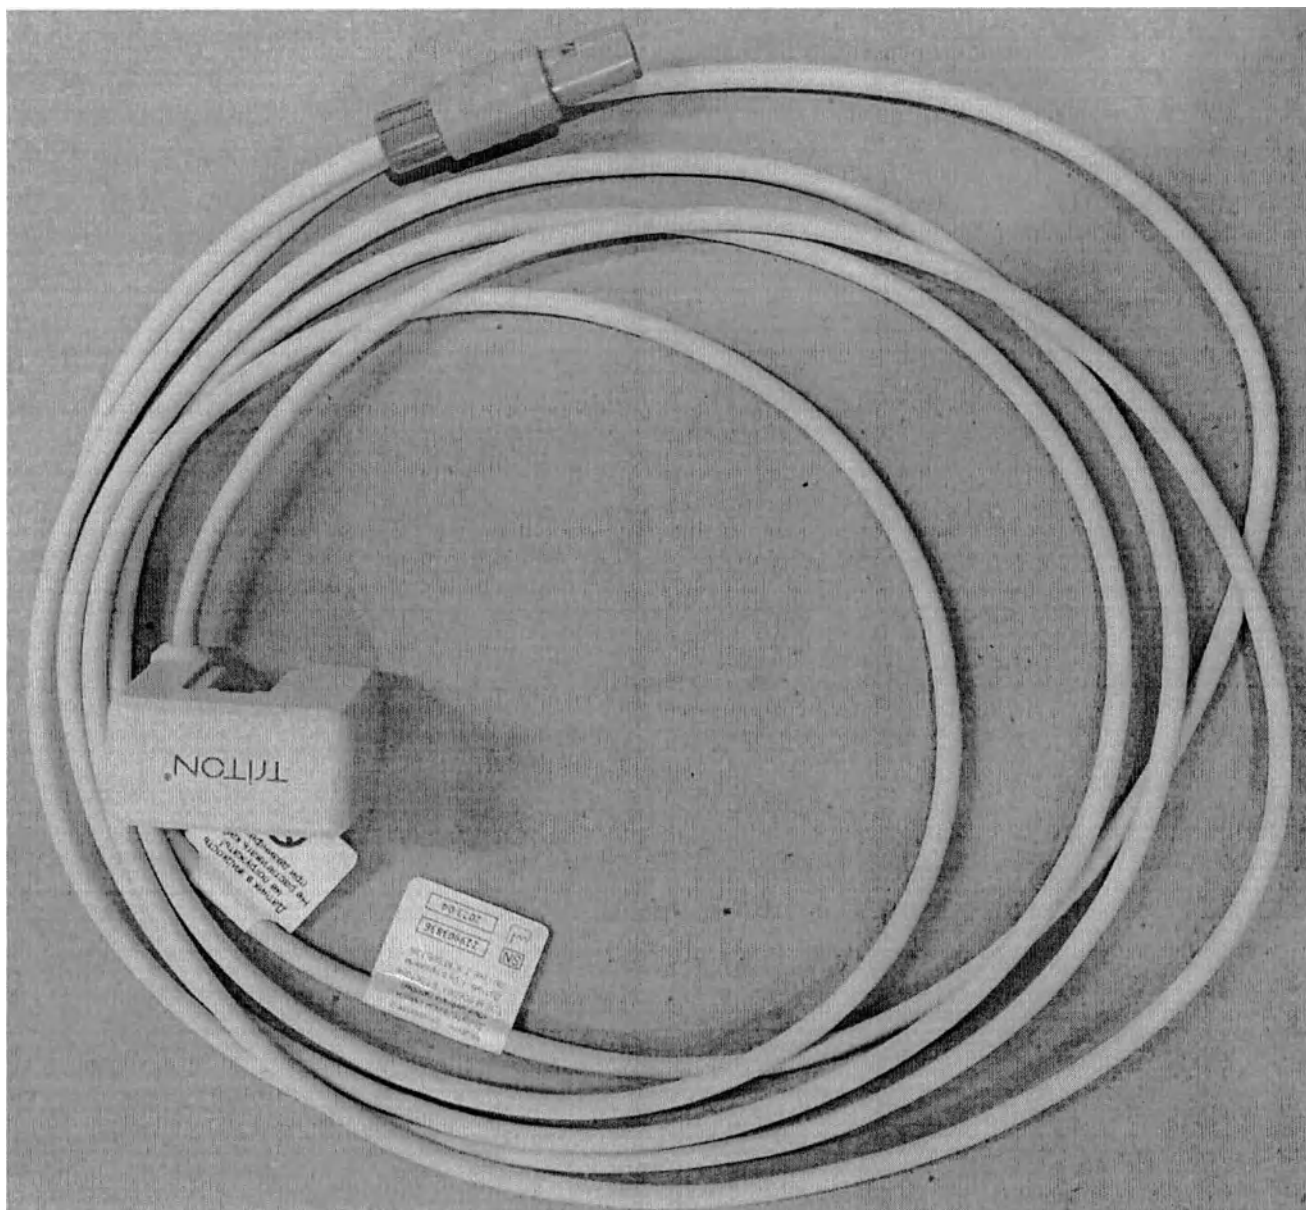


43.1 Датчик CO2 в прямом потоке, ТЭСМ.506138, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Модуля газоанализатора дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

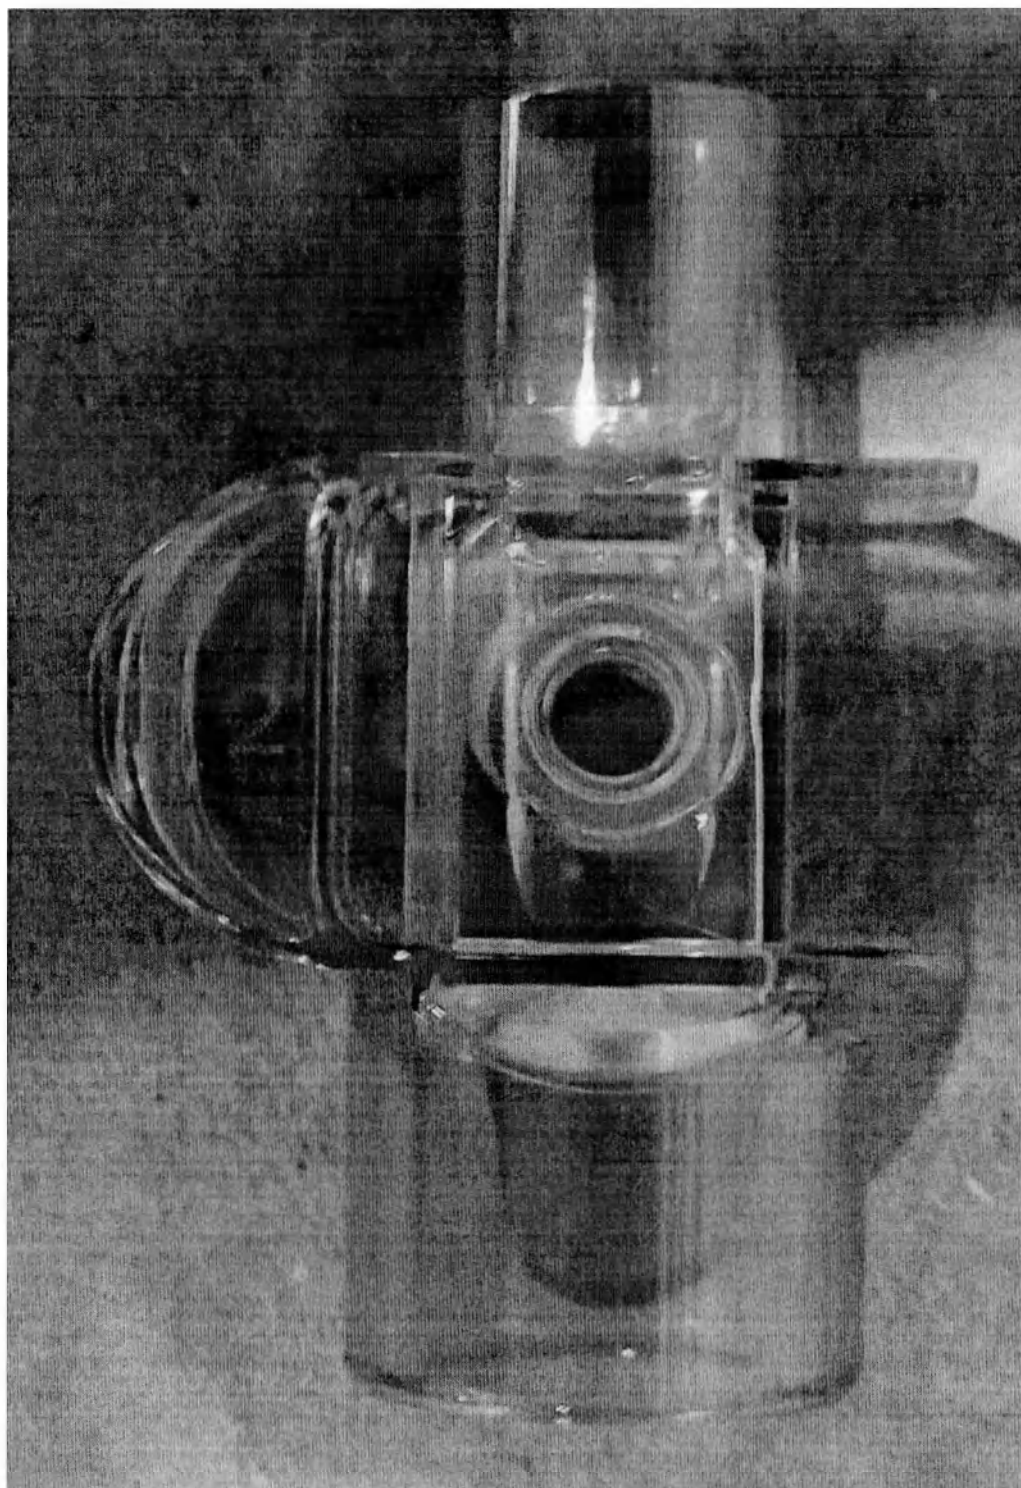


43.2 Вентиляционный адаптер взрослый/детский, ТЭСМ.706020, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Модуля газоанализатора дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

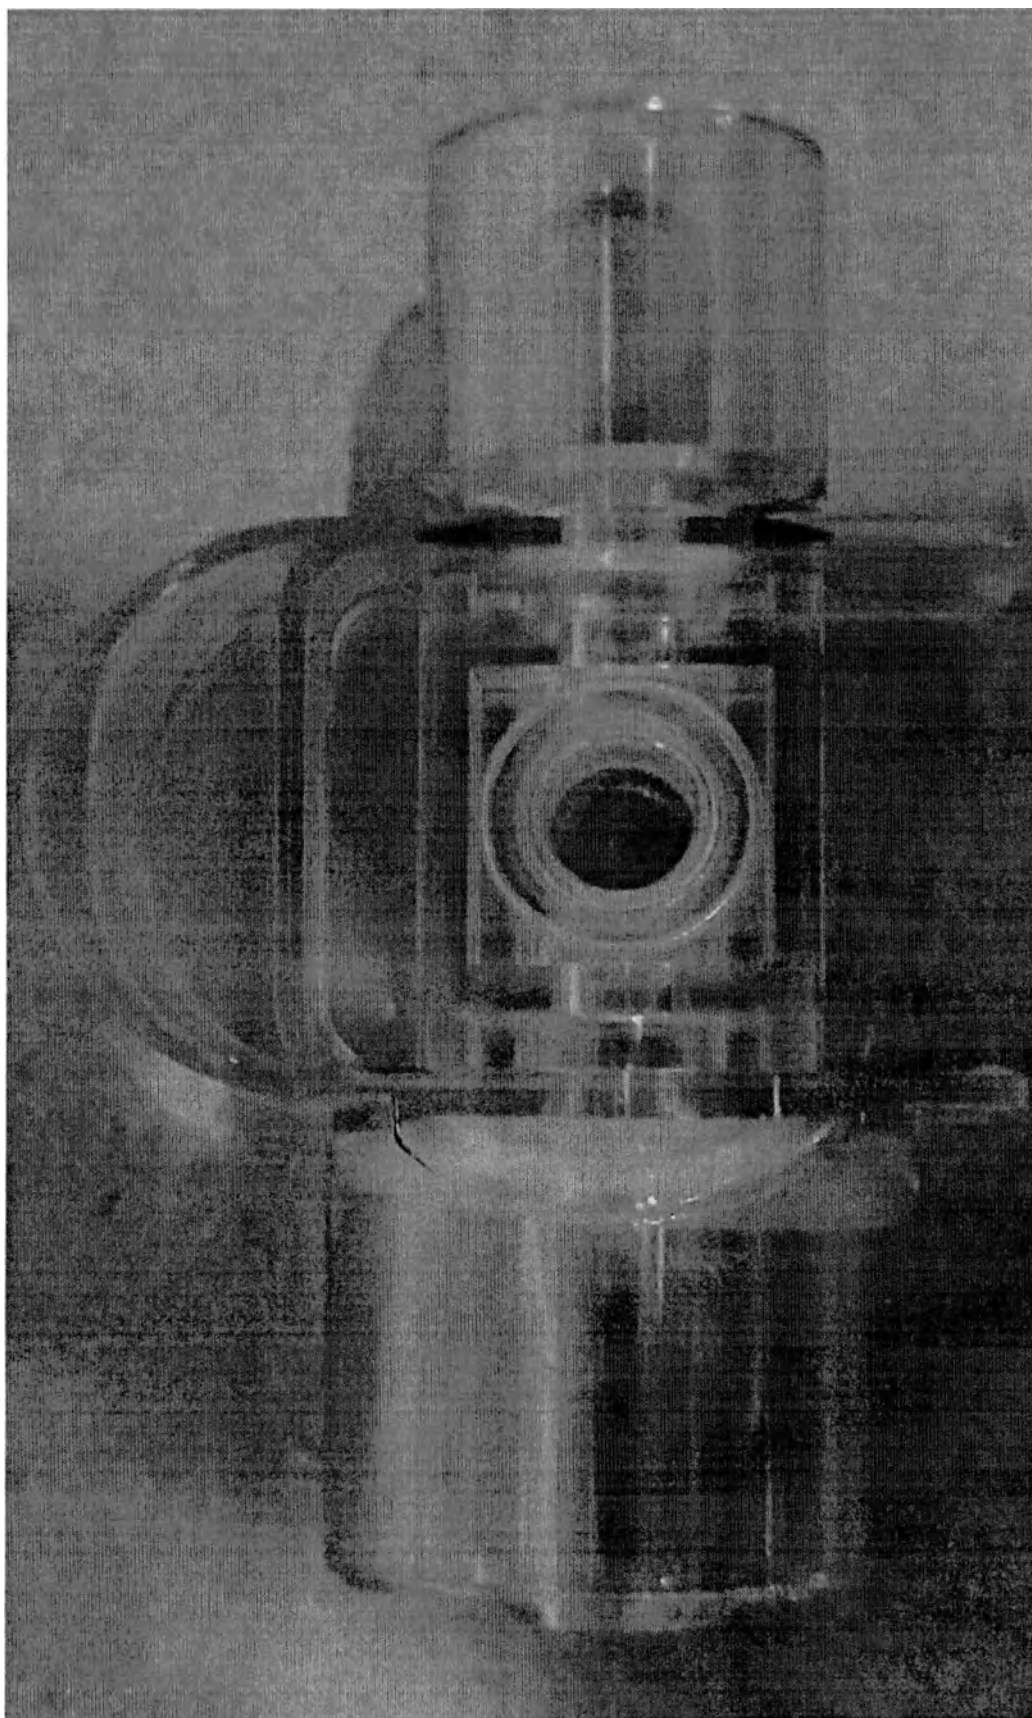


43.3 Вентиляционный адаптер детский/неонатальный, ТЭСМ.706021, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Модуля газоанализатора дыхательной смеси (без отбора пробы), ТЭСМ.506001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

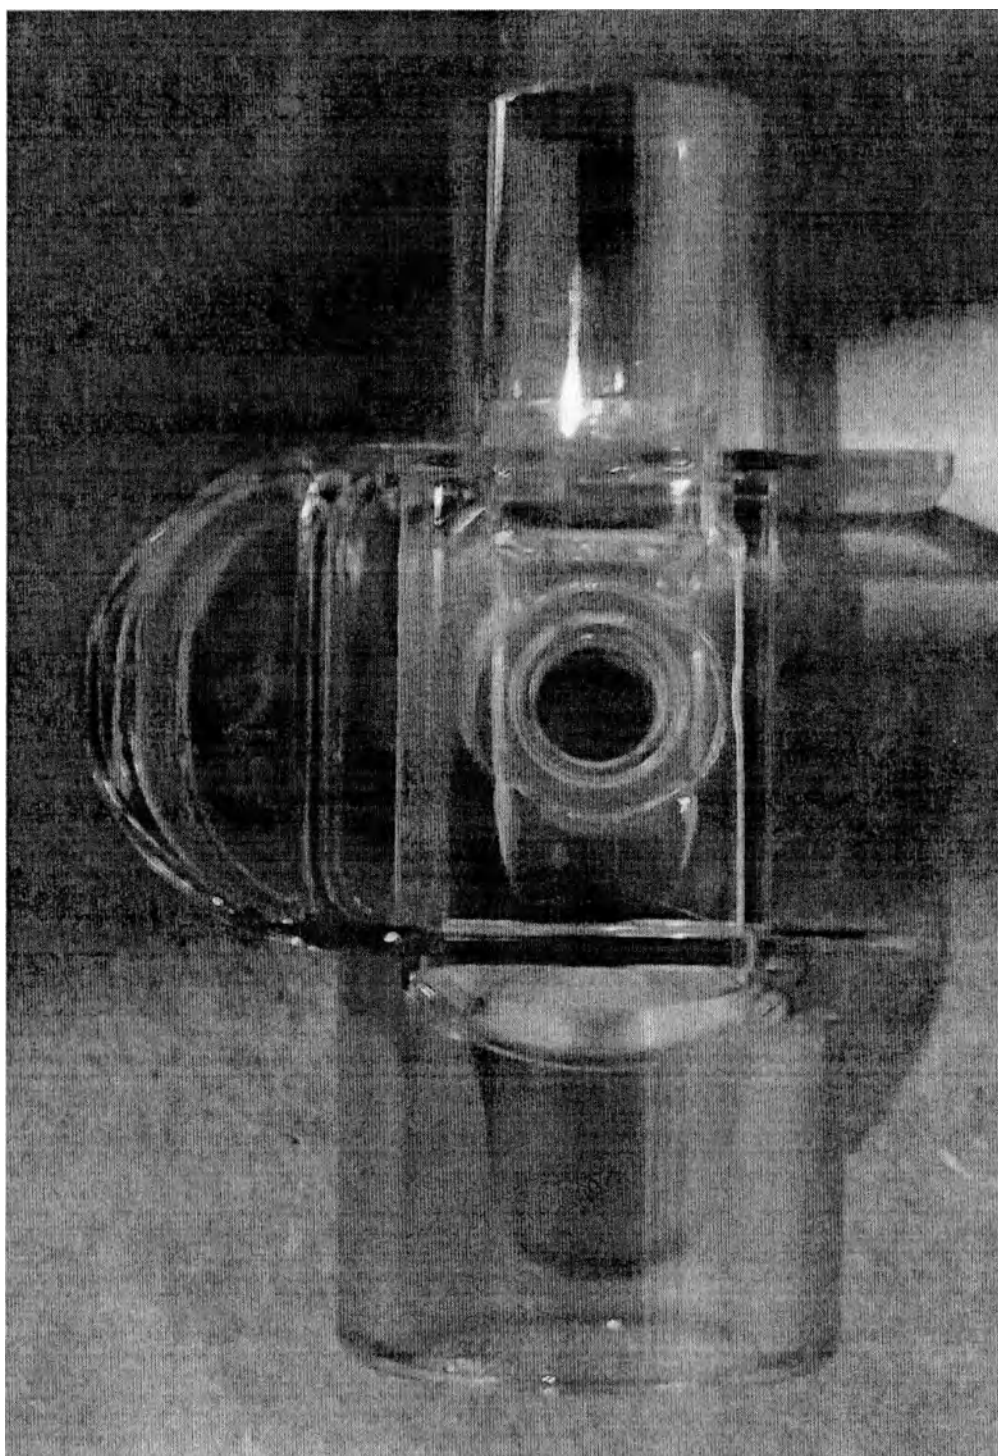


**44 Вентиляционный адаптер взрослый/детский, ТЭСМ.706020, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия**

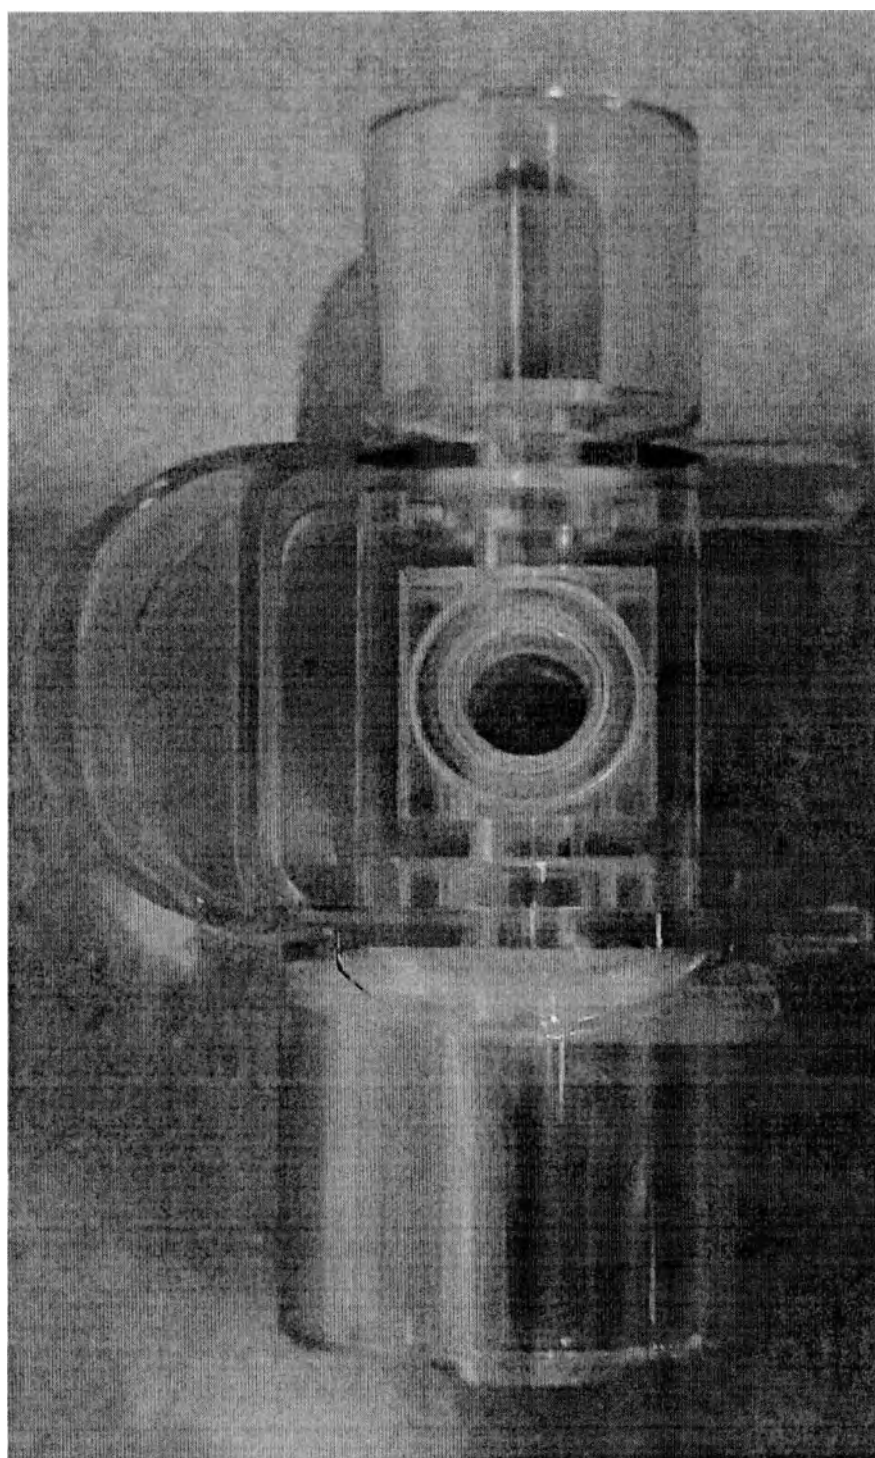

**45 Вентиляционный адаптер детский/неонатальный, ТЭСМ.706021, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия**

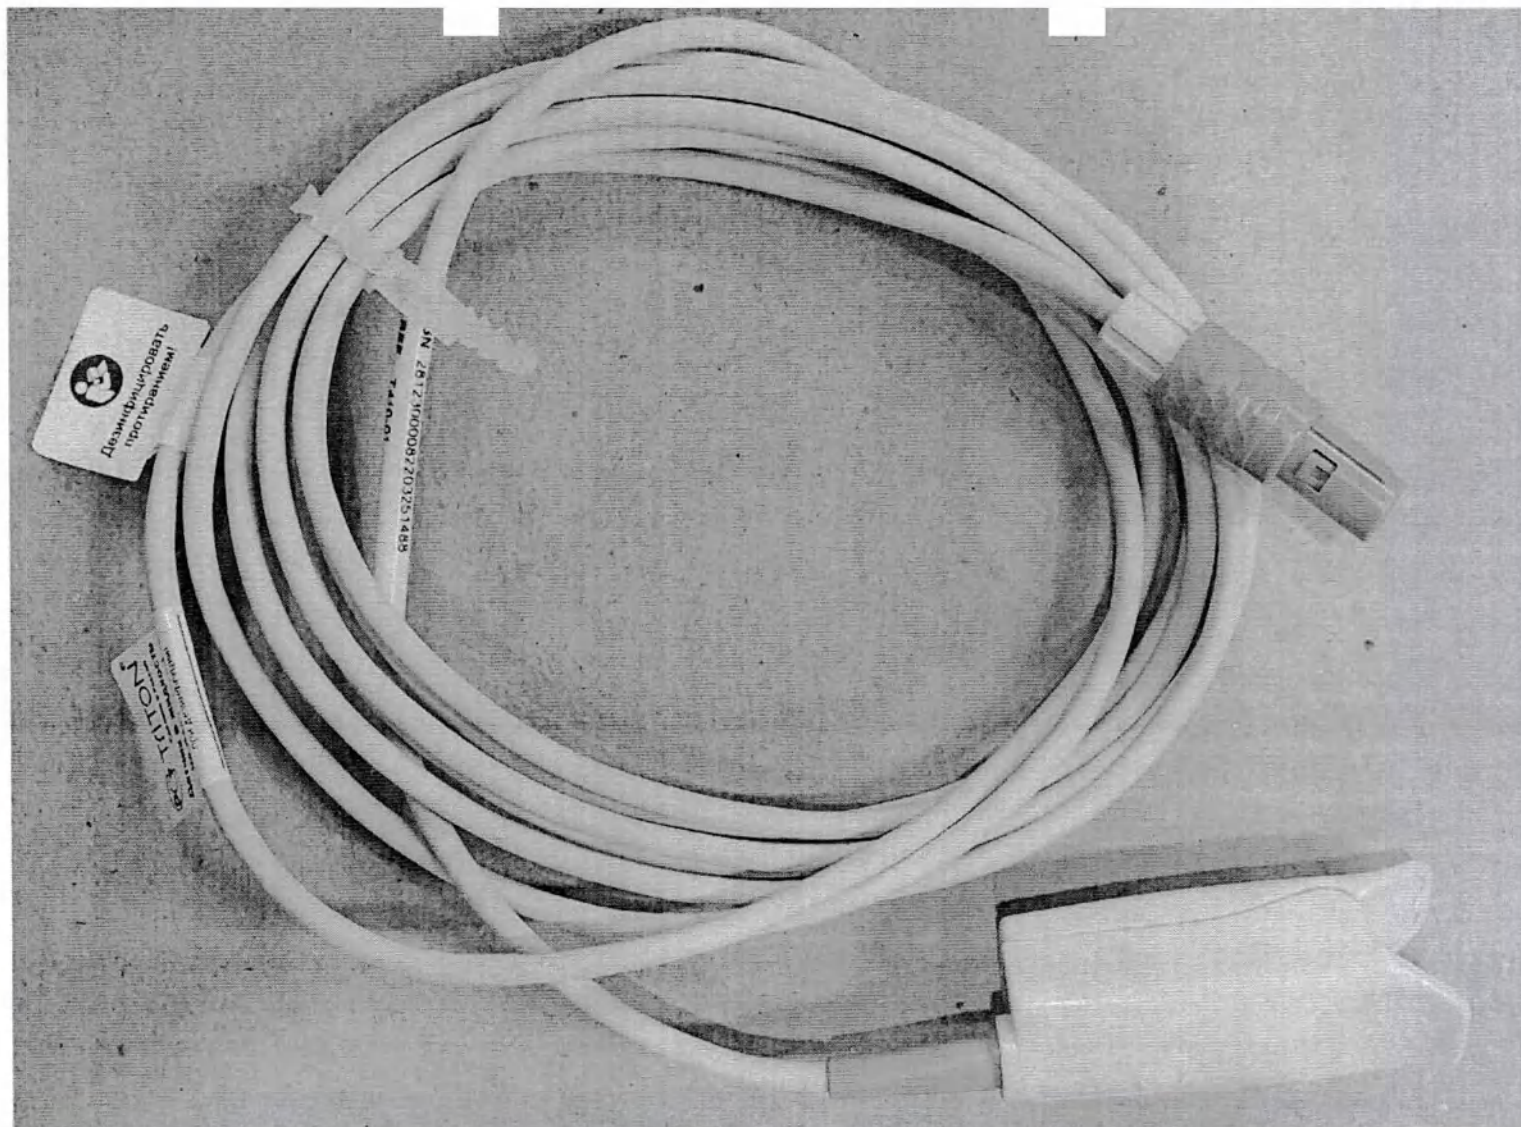


46 Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПП-«Тритон» по ТУ 9441-009-32119398-2001, РУ № ФСР 2011/11675, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

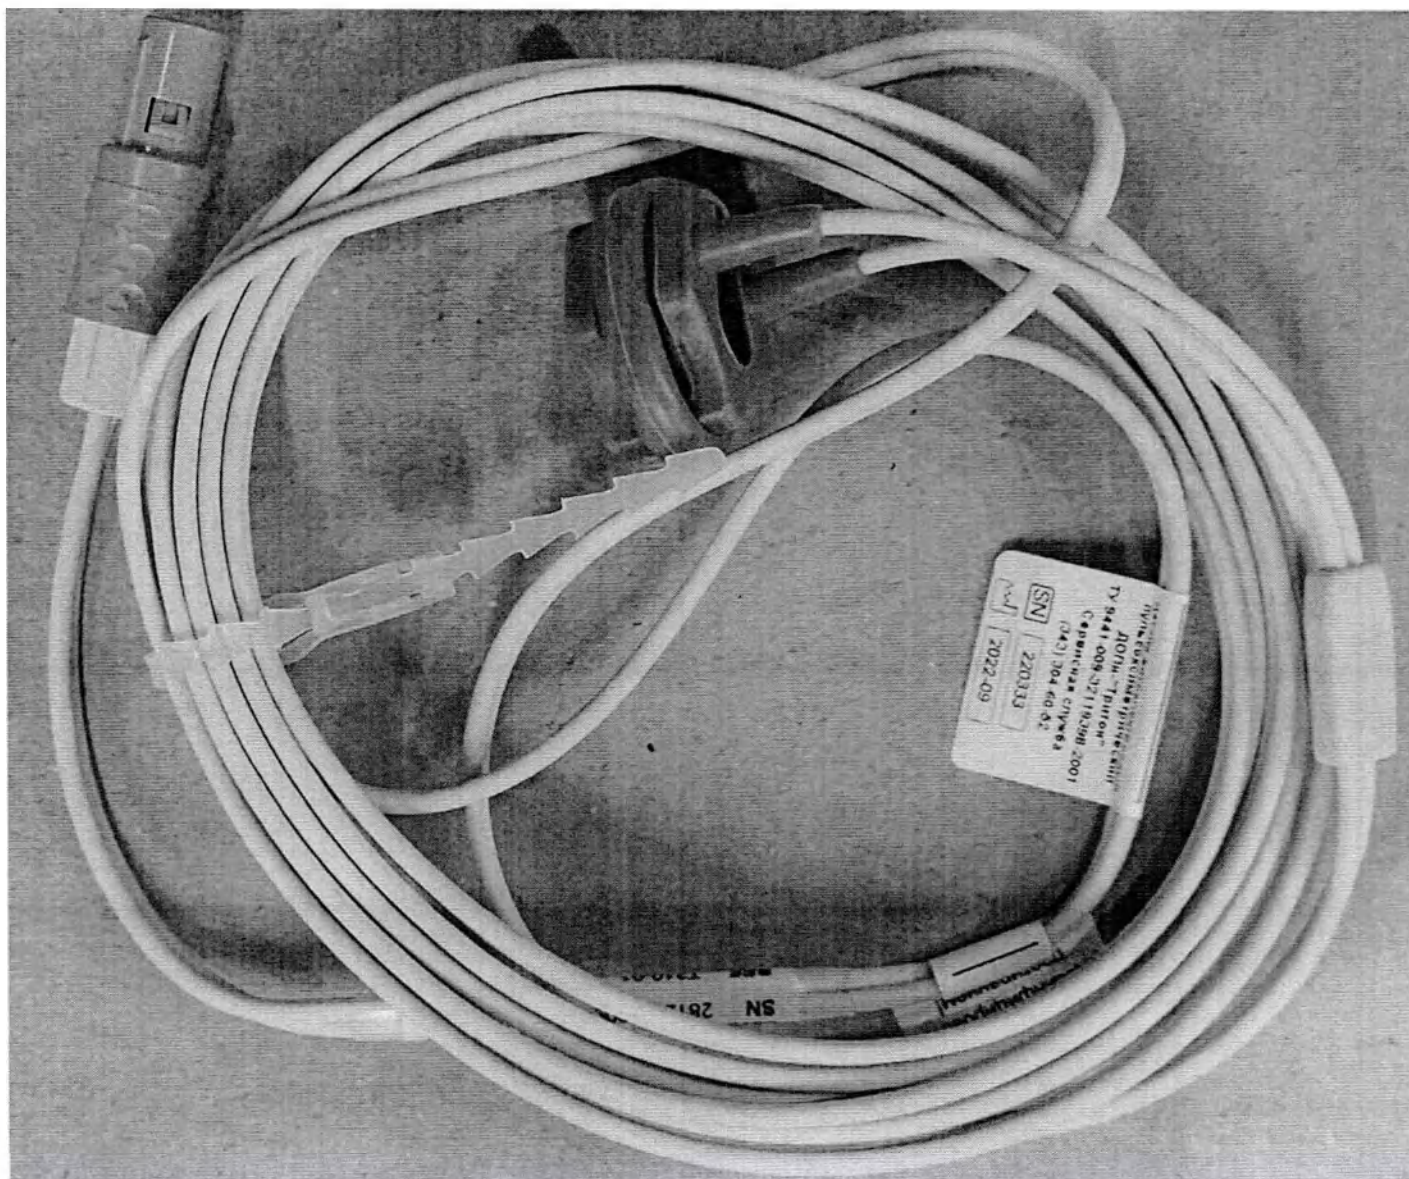


47 Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОН-«Тритон» по ТУ 9441-009-32119398-2001, РУ № ФСР 2011/11675,


ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

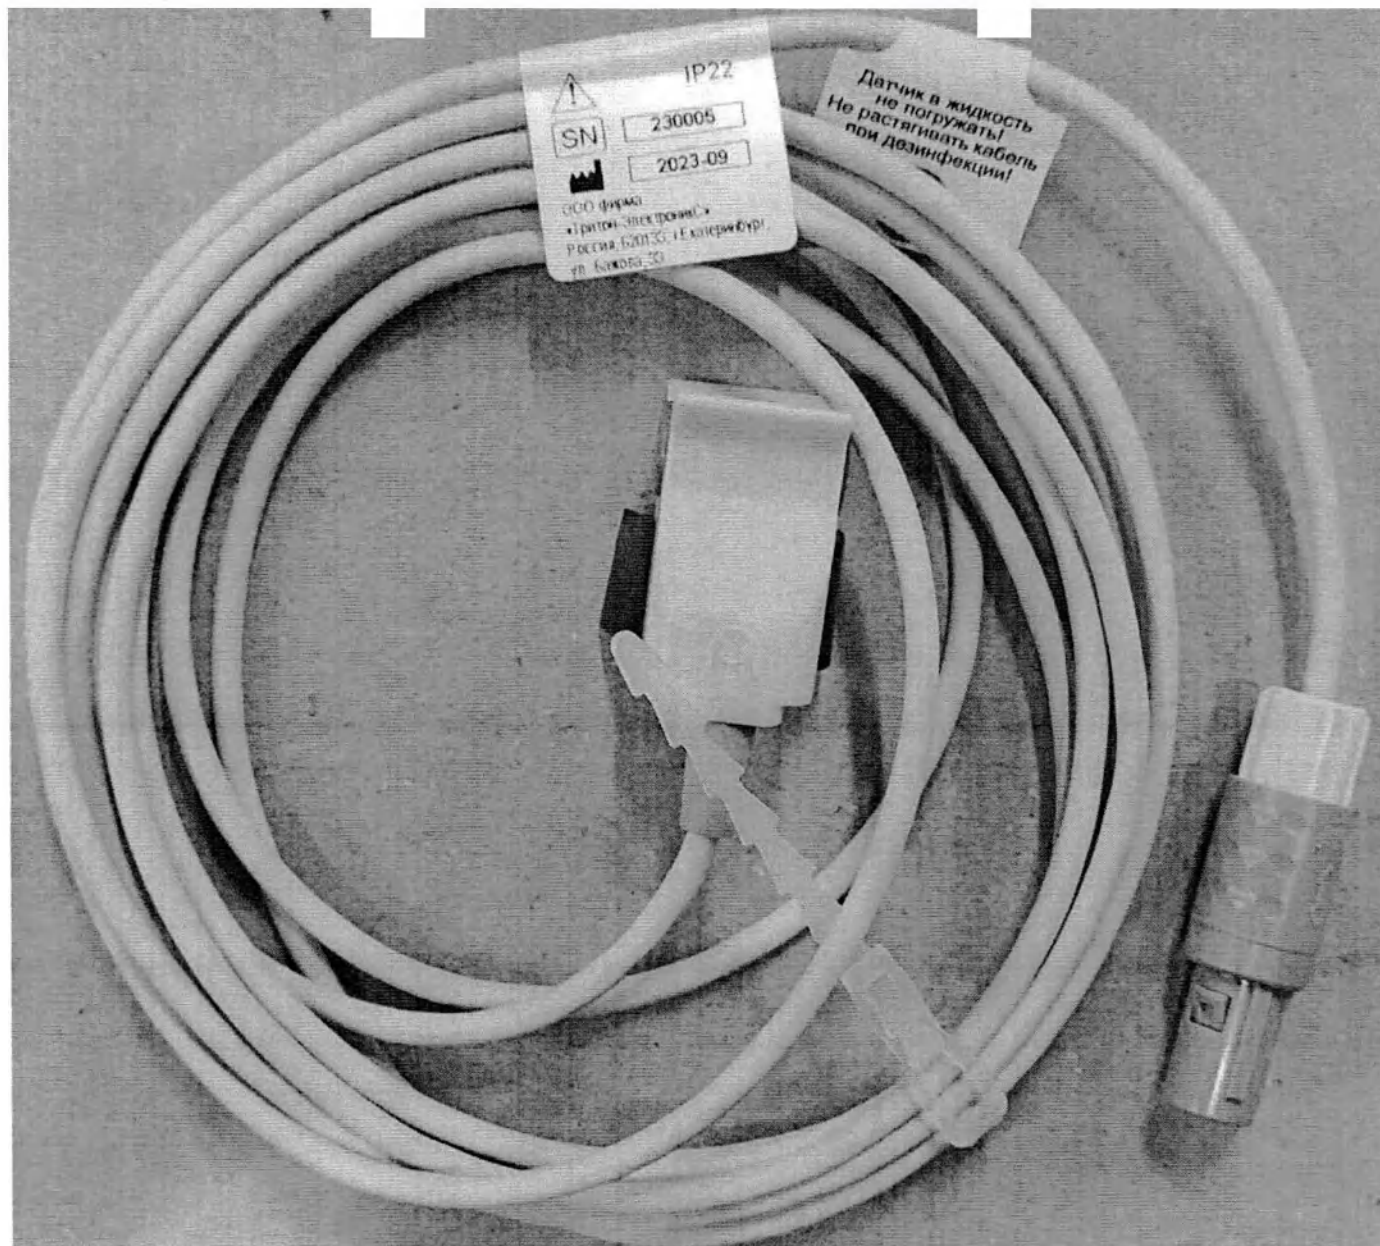


48 Датчик пульсоксиметрический педиатрический, клипса, ТЕСМ.096011, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

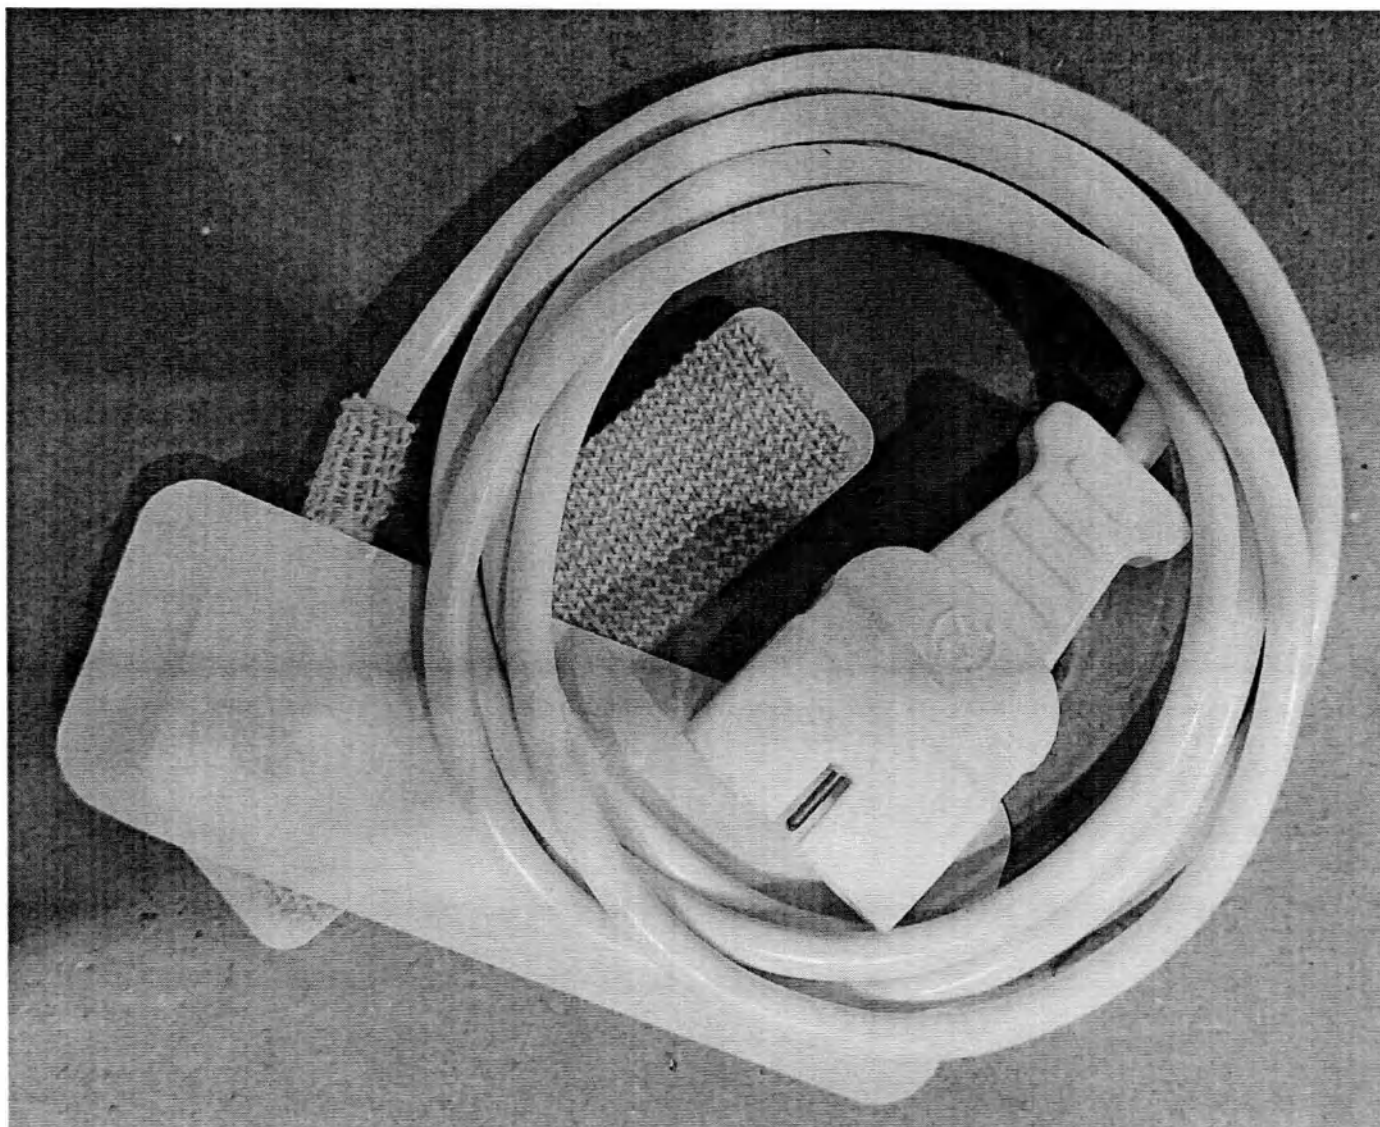


49 Датчик пульсоксиметрический одноразовый, детский, самоклеящийся, TECH.096021, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

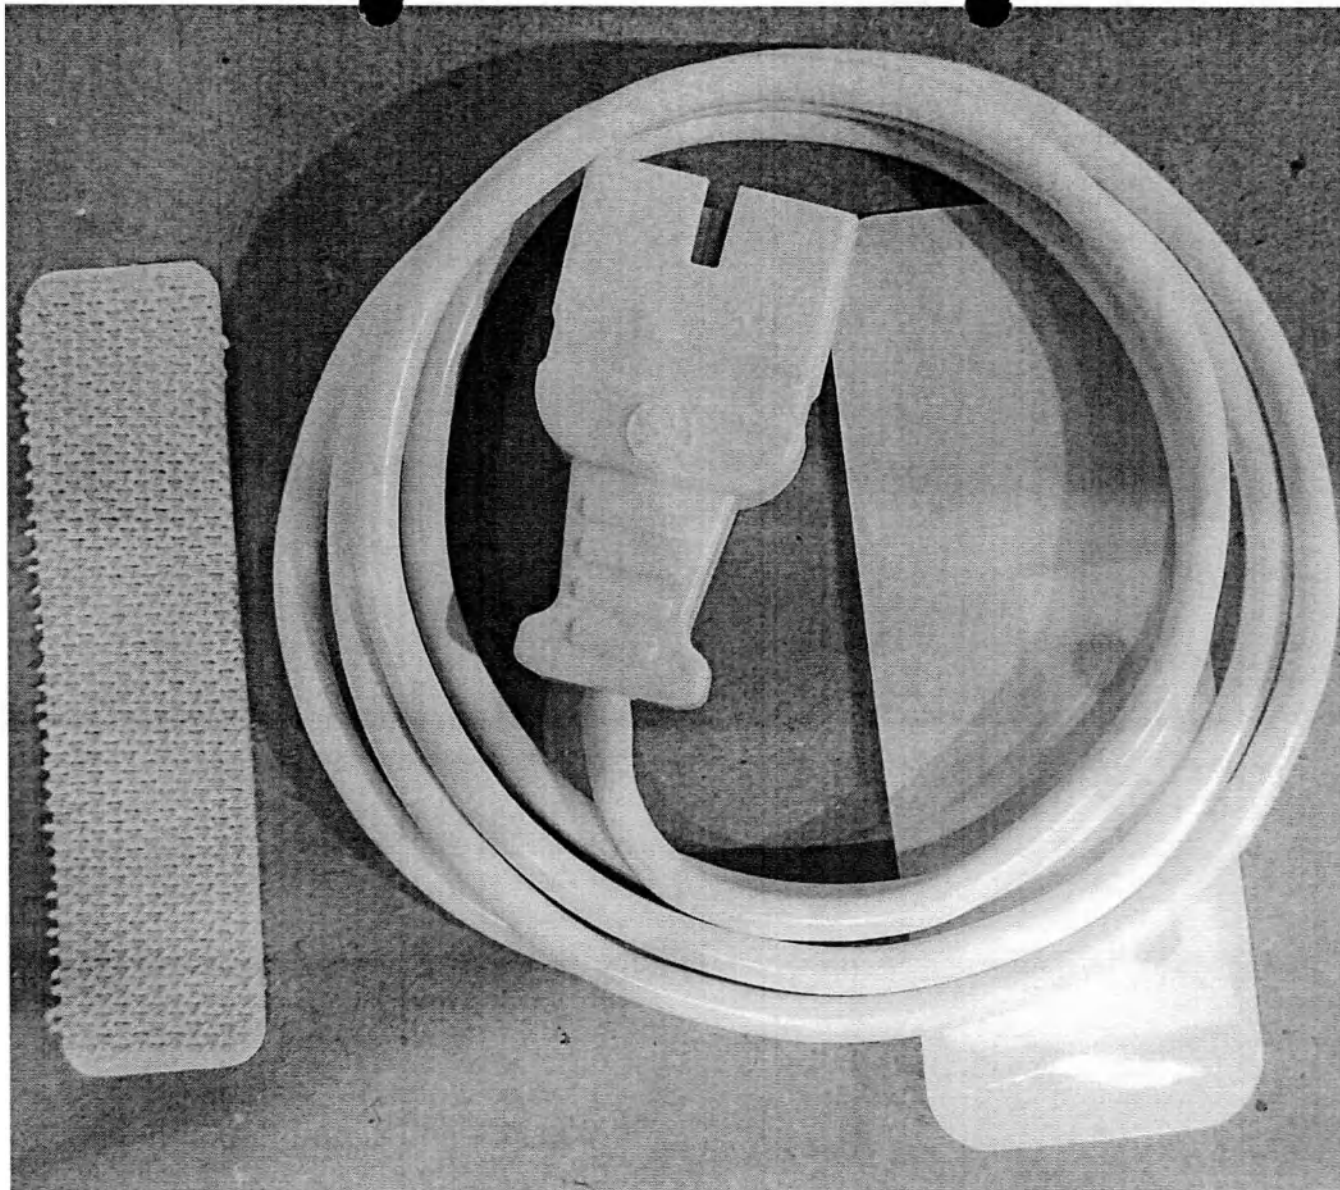


49 Датчик пульсоксиметрический одноразовый, детский, самоклеящийся, TECH.096021-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

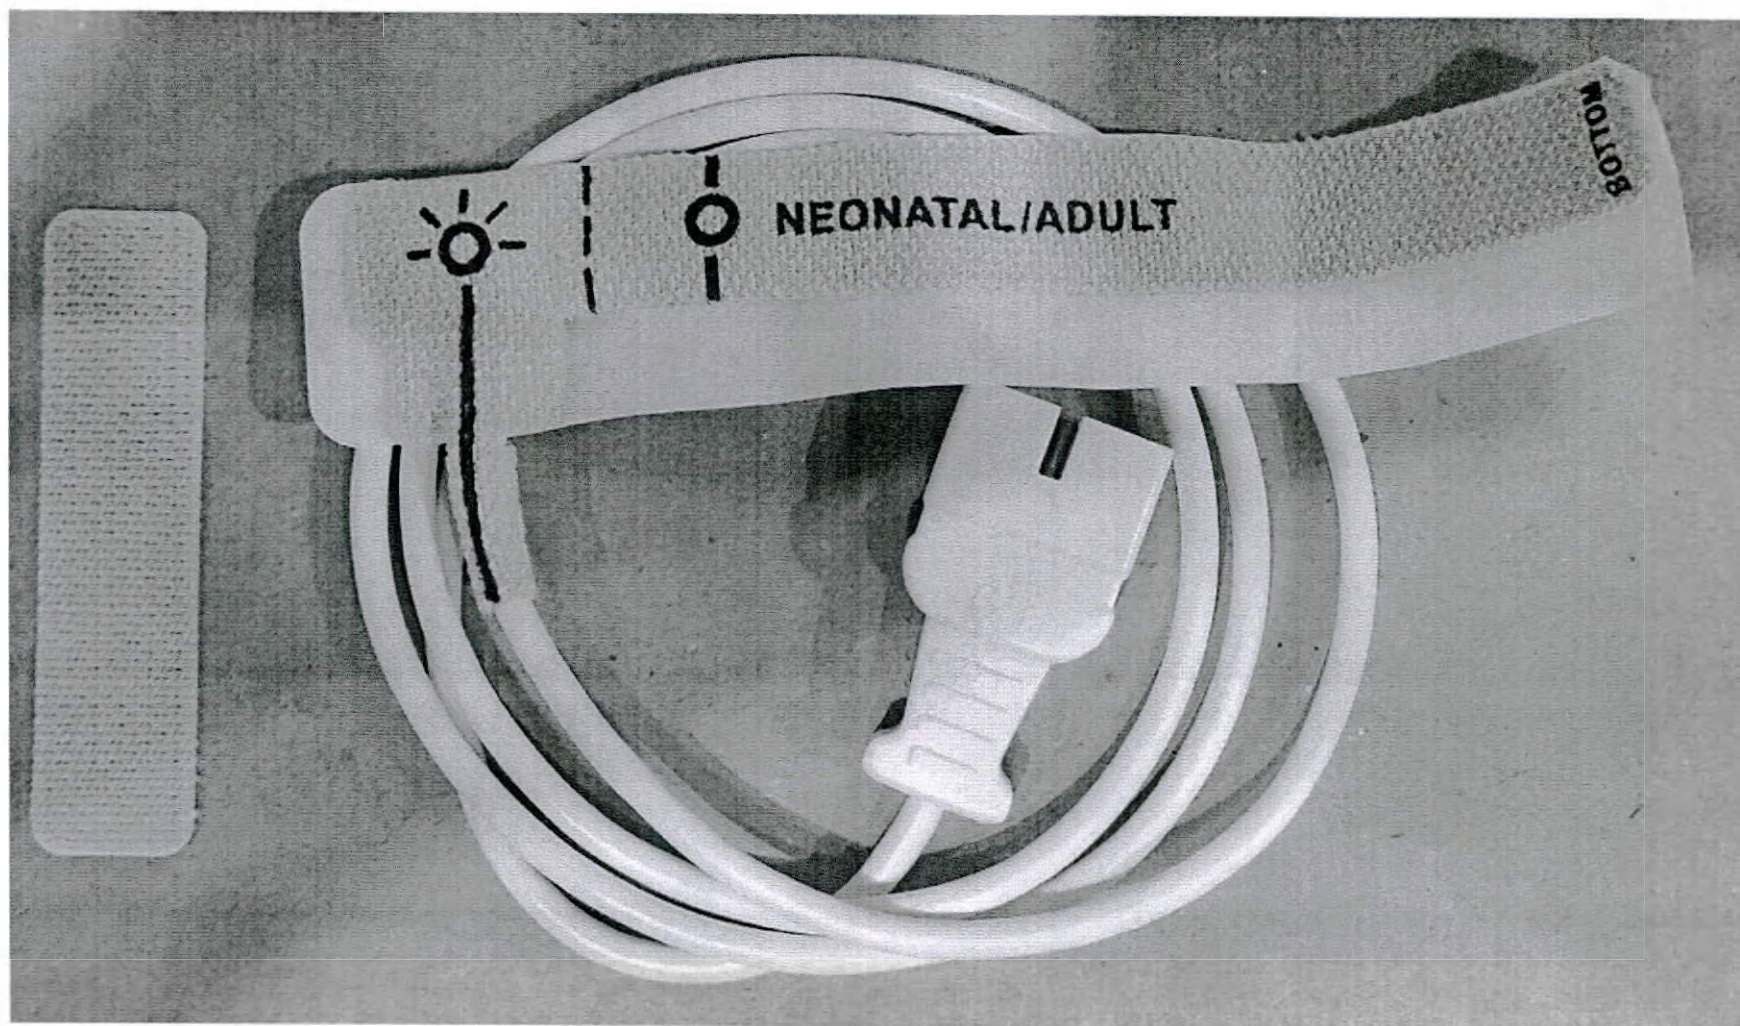

50 Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, самоклеящийся, TECH.096022, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

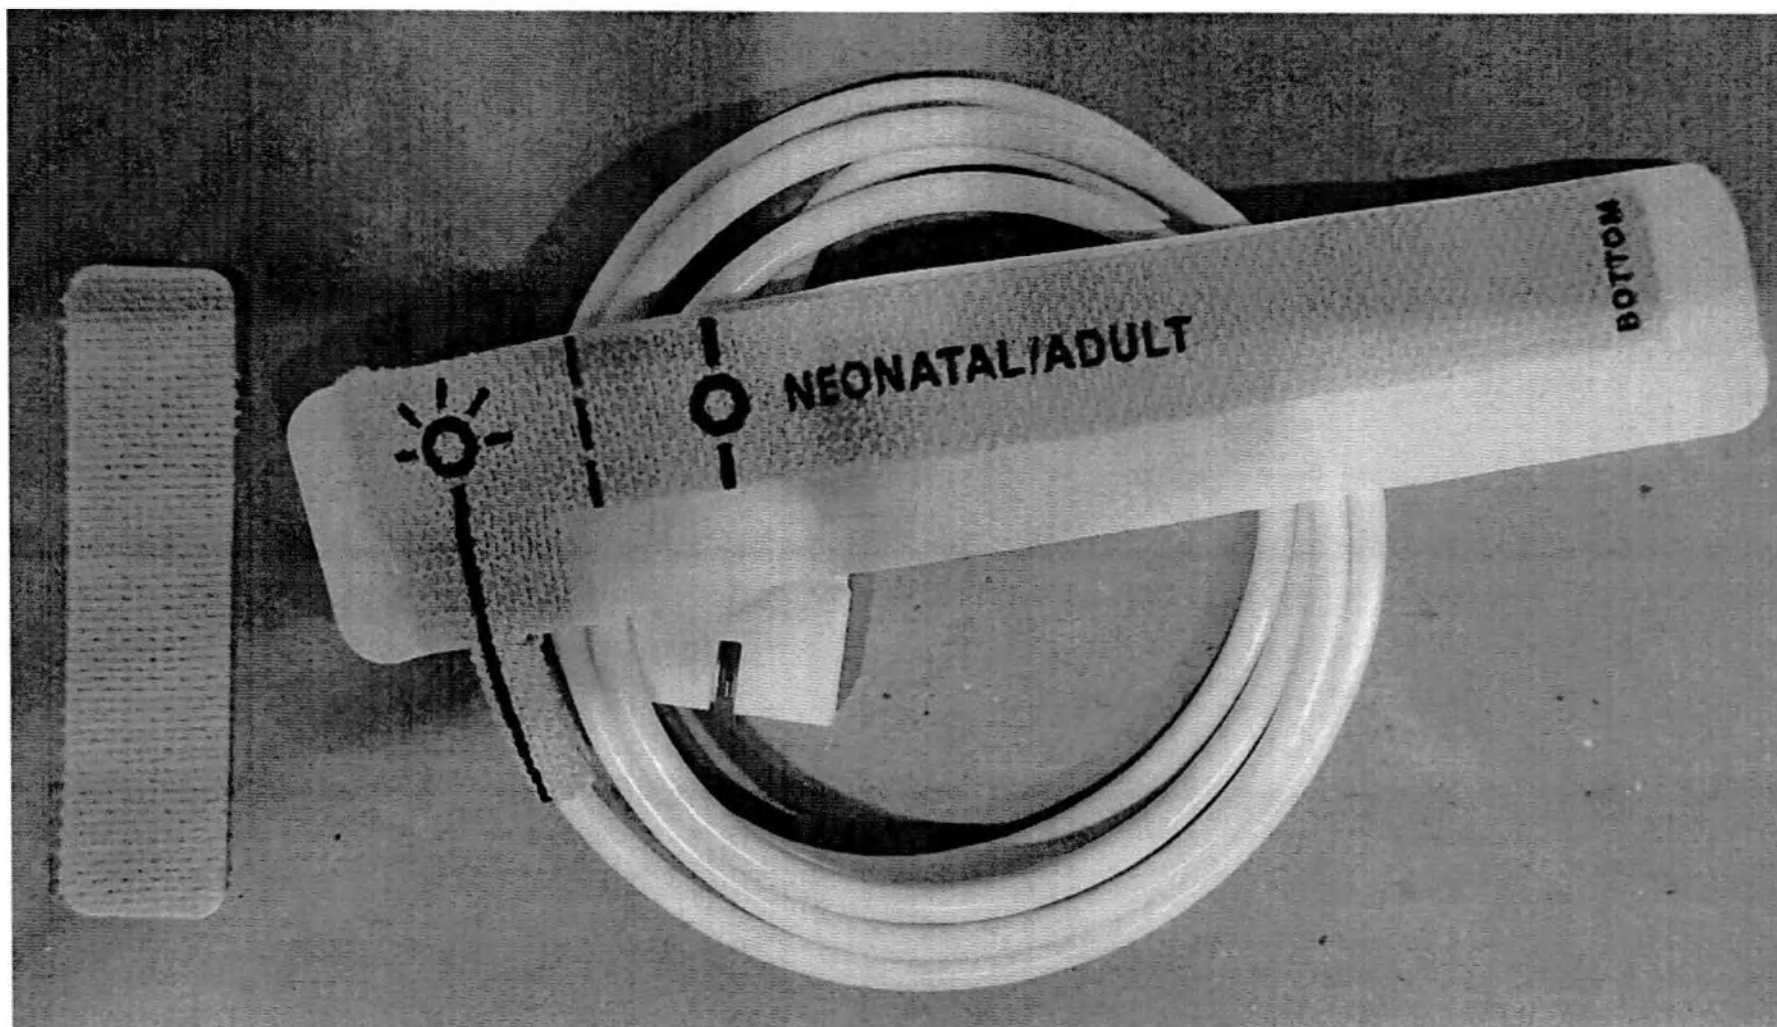


50 Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, самоклеящийся, ТЕСН.096022-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

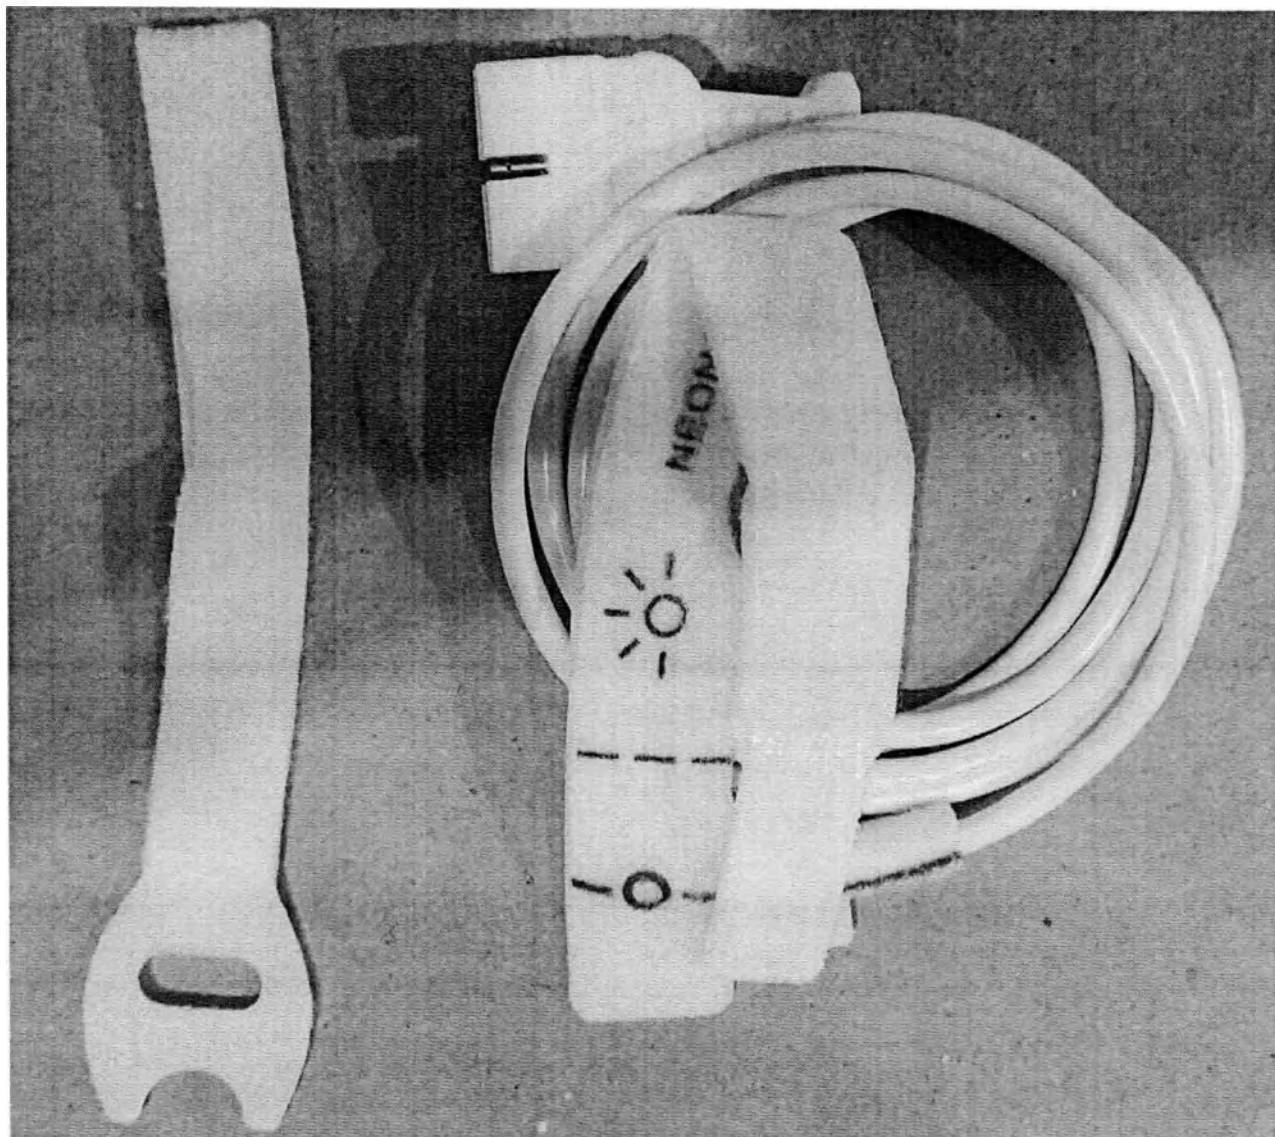


51 Датчик пульсоксиметрический одноразовый, взрослый/неонатальный, текстильная застежка, ТЕСН.096027,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия




51 Датчик пульсоксиметрический одноканальный, взрослый/неонатальный, текстильная застежка, ТЕСН.096027-01,
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

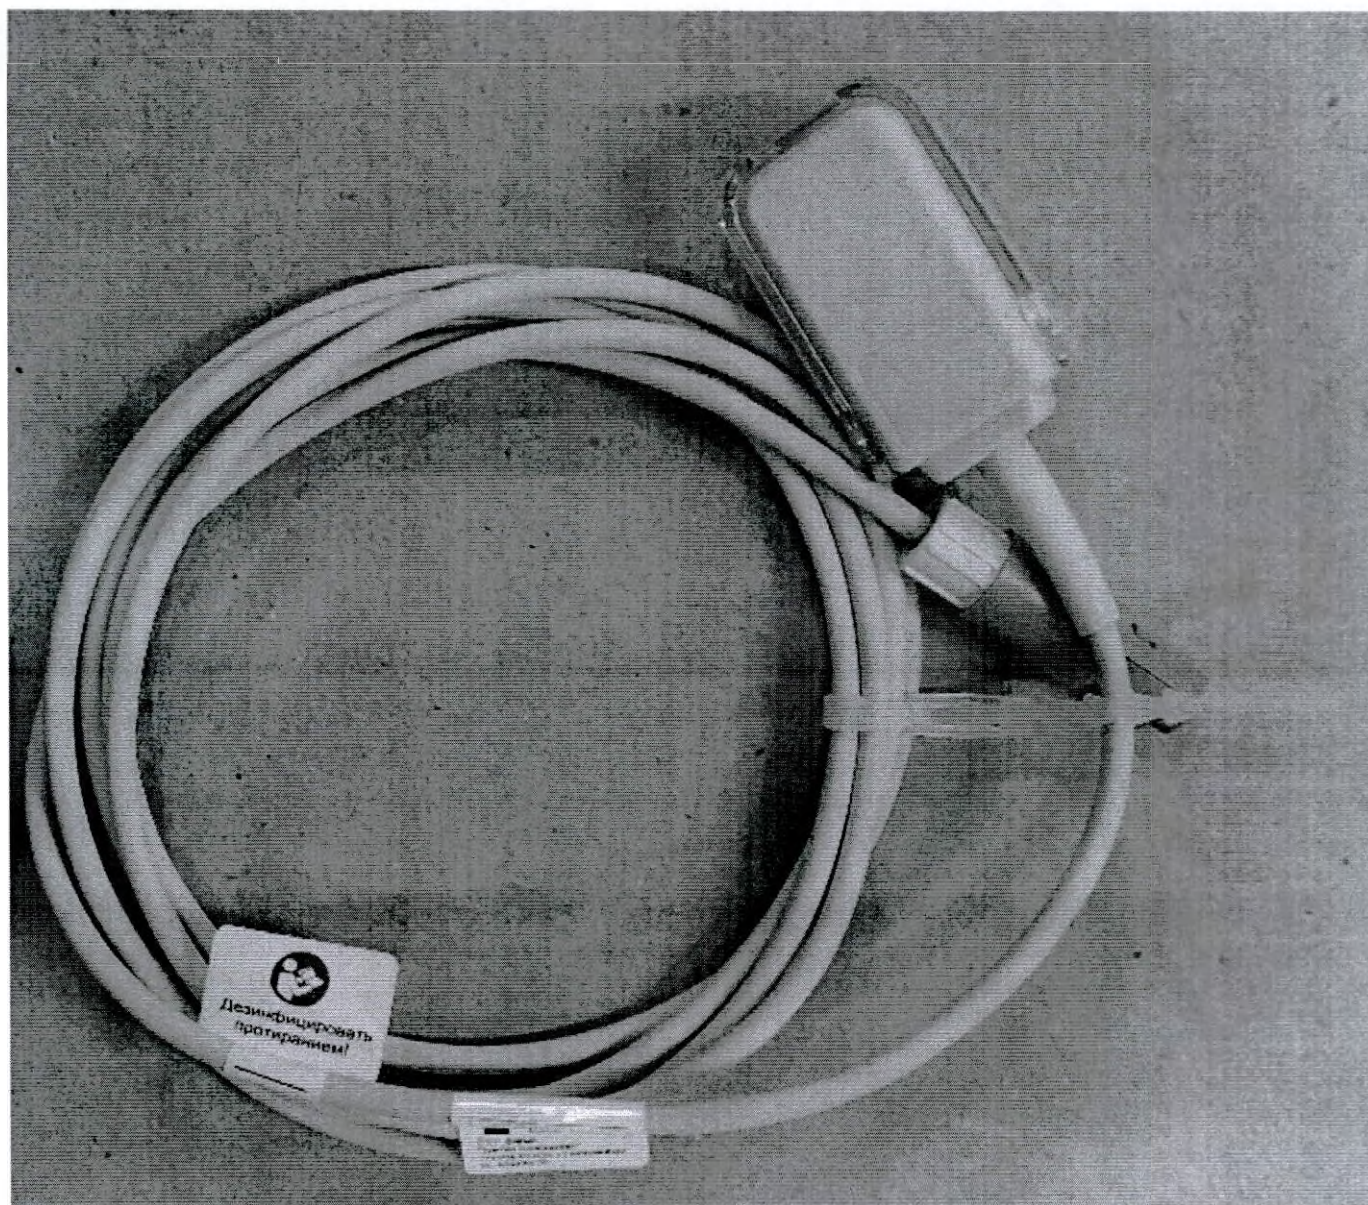


52 Переходник датчика пульсоксиметрического, ТЭСМ.534014-01, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

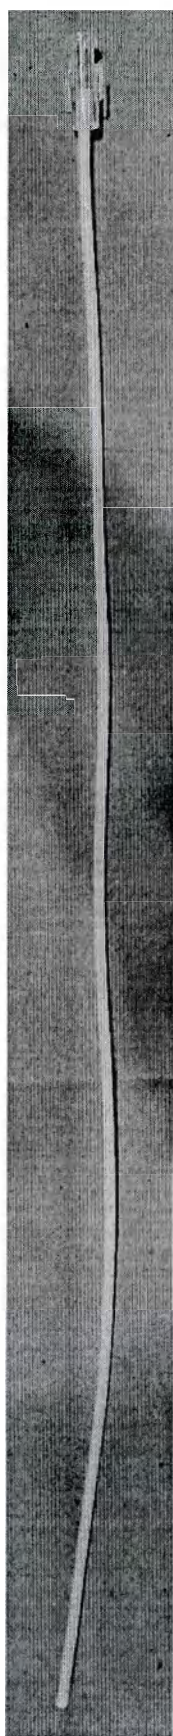

53 Катетер, ТЭСМ.046502, ТУ 32.50.13-036-32119398-2023, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

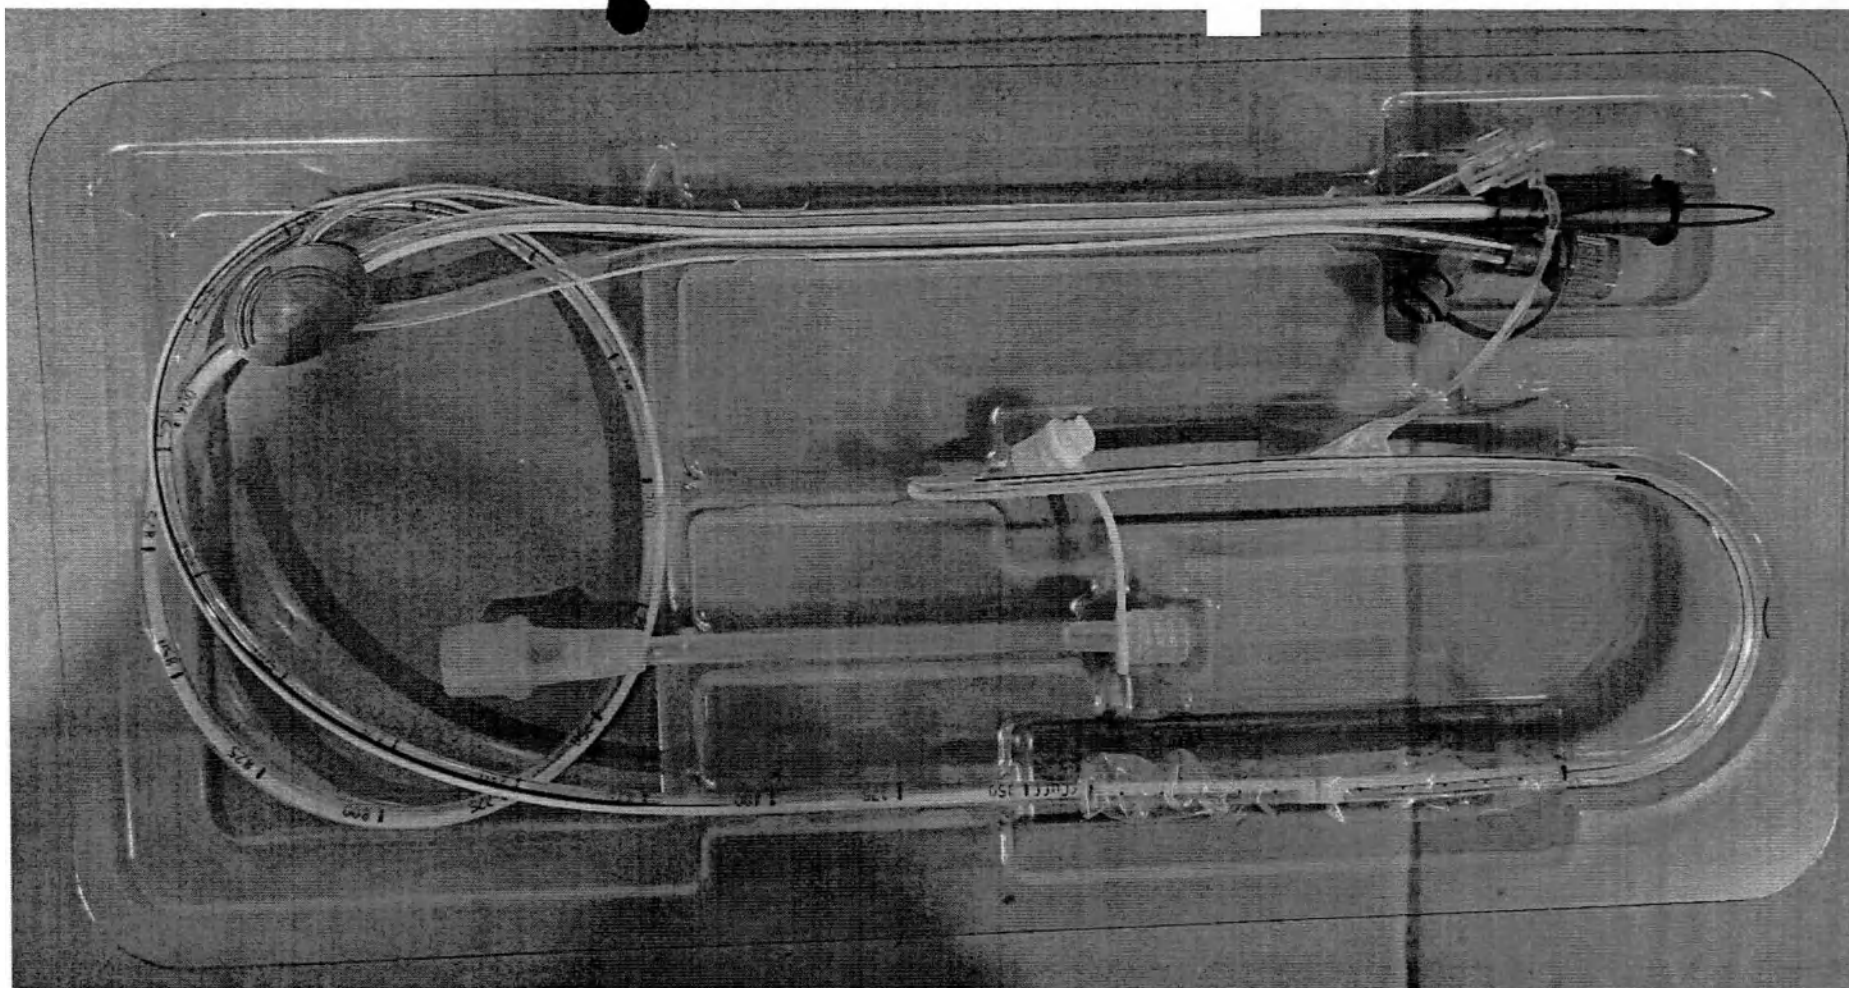


54 Изделия медицинские зондирующие, бужирующие: зонд желудочный, LM-AZ-380211, РУ № ФСЗ 2011/10498, Медикопласт Интернешнл ГмбХ (MEDICOPLAST International GmbH), Германия

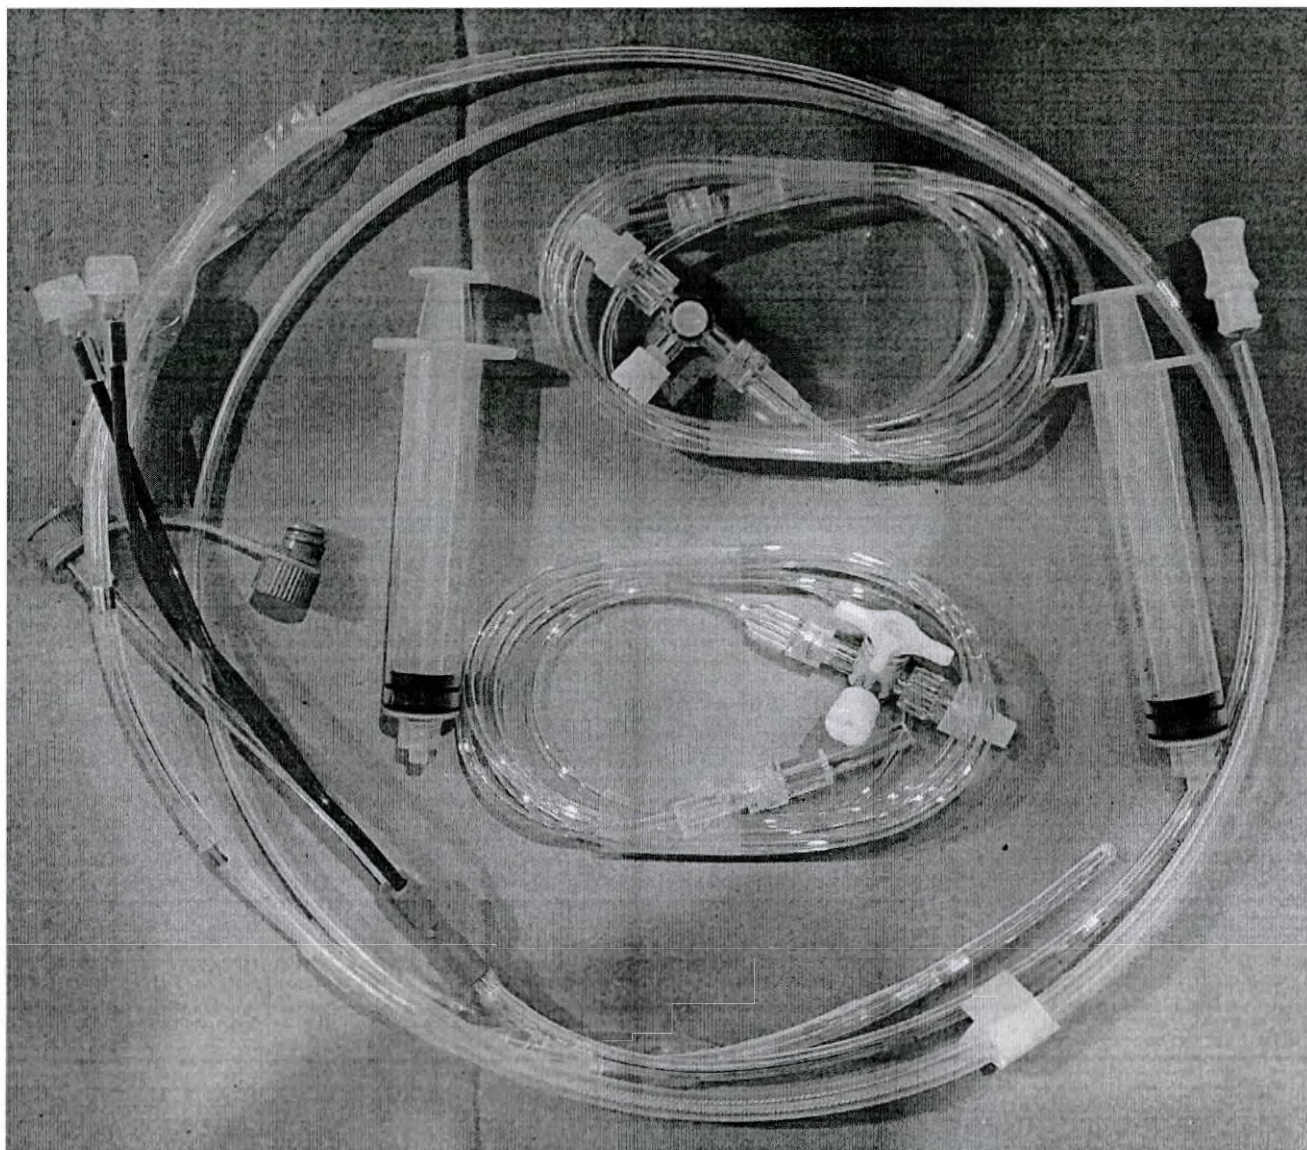


55 Катетер назогастальный многофункциональный (пищеводный двухбаллонный взрослый), 09031015, SIDAM s.r.l., Италия




56 Фильтр дисковый, 010-740, Flexicare Medical Limited, Великобритания

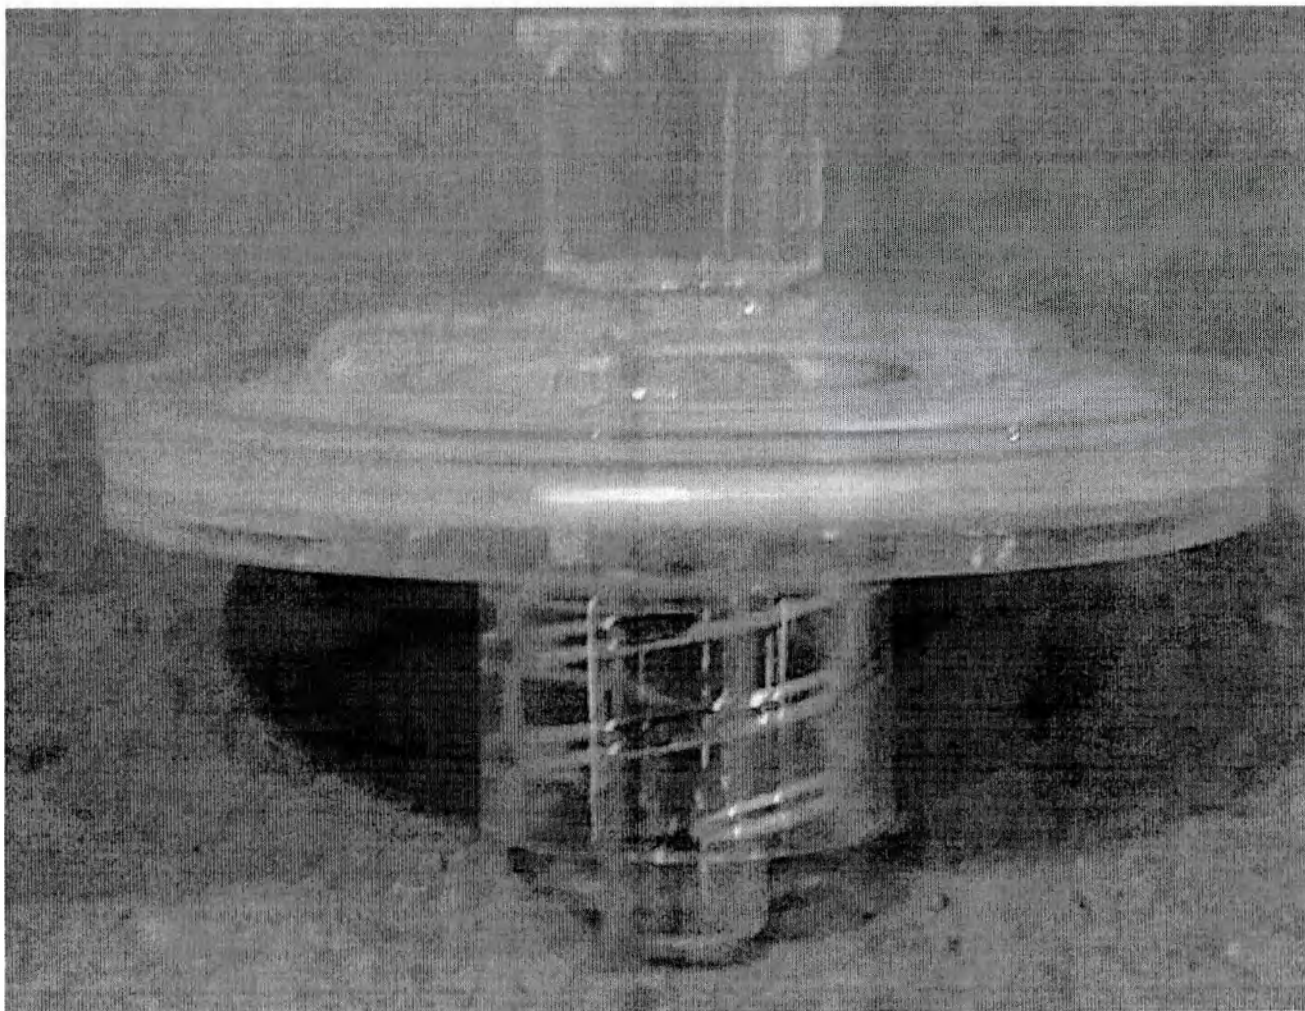

56 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательный вирусно-бактериальный фильтр: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, 2715000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd.)

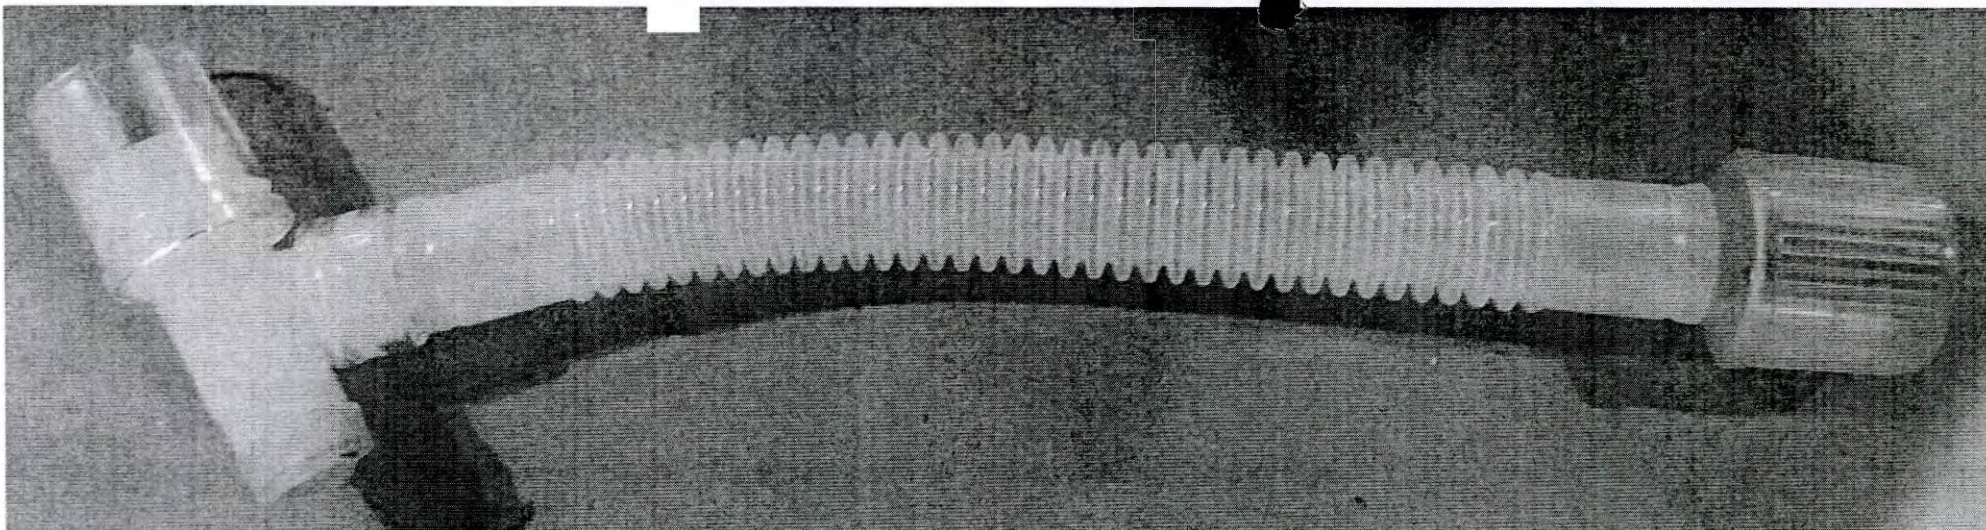


57 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель с портом: гибкий, шарнирный, угловой, 3505000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd.)

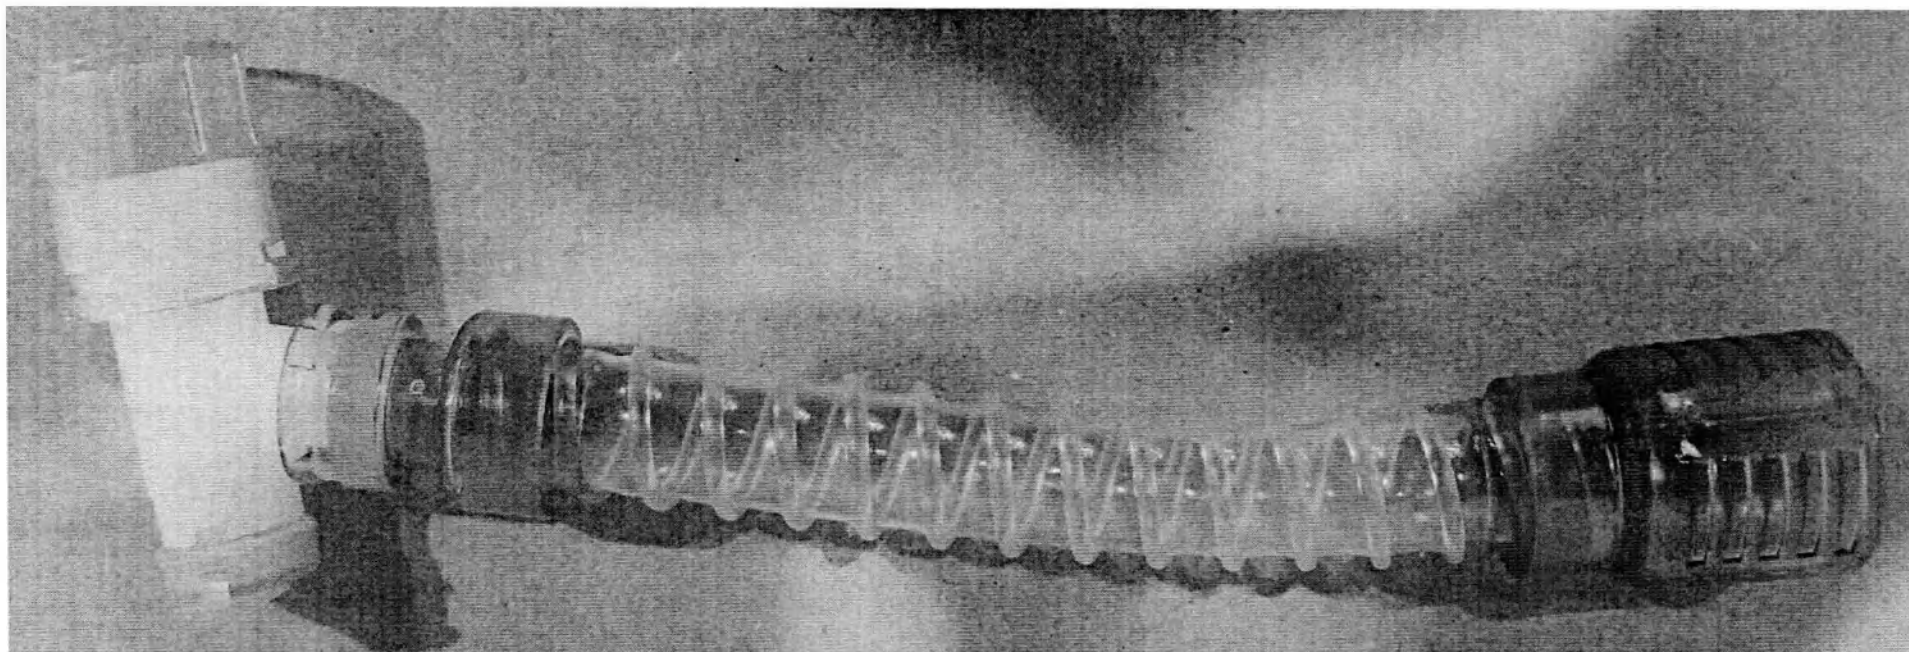


57 Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: соединитель с портом: гибкий, шарнирный, угловой, 5180000, РУ № ФСЗ 2009/03551, «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (Intersurgical Ltd.)




58.1 Кабель датчика потока, ТЭСМ.236116, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Модуля потока внешний, ТЭСМ.236001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

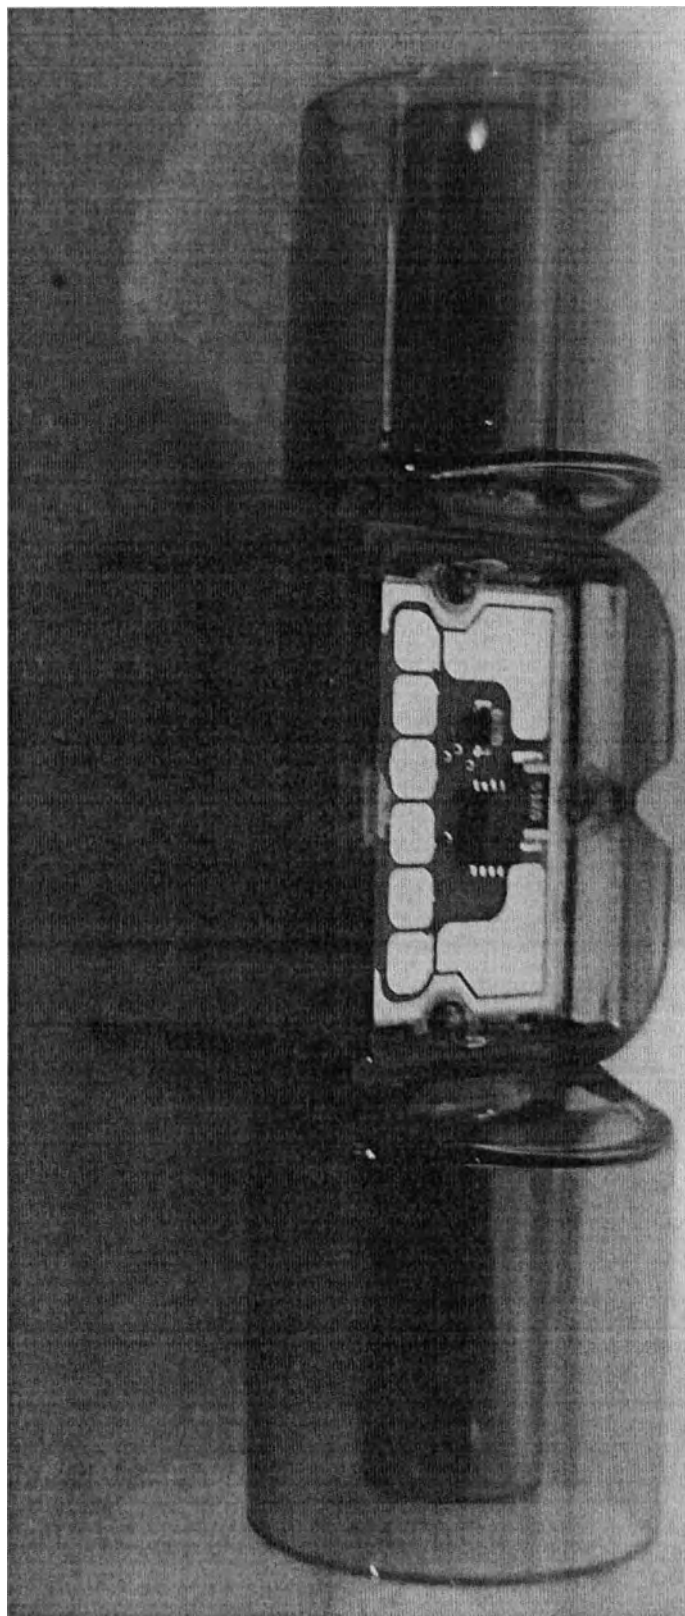


58.2 Датчик потока многоразовый, SFM3400-33-AW, Sensirion, Швейцария, в составе Модуля потока внешний, ТЭСМ.236001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

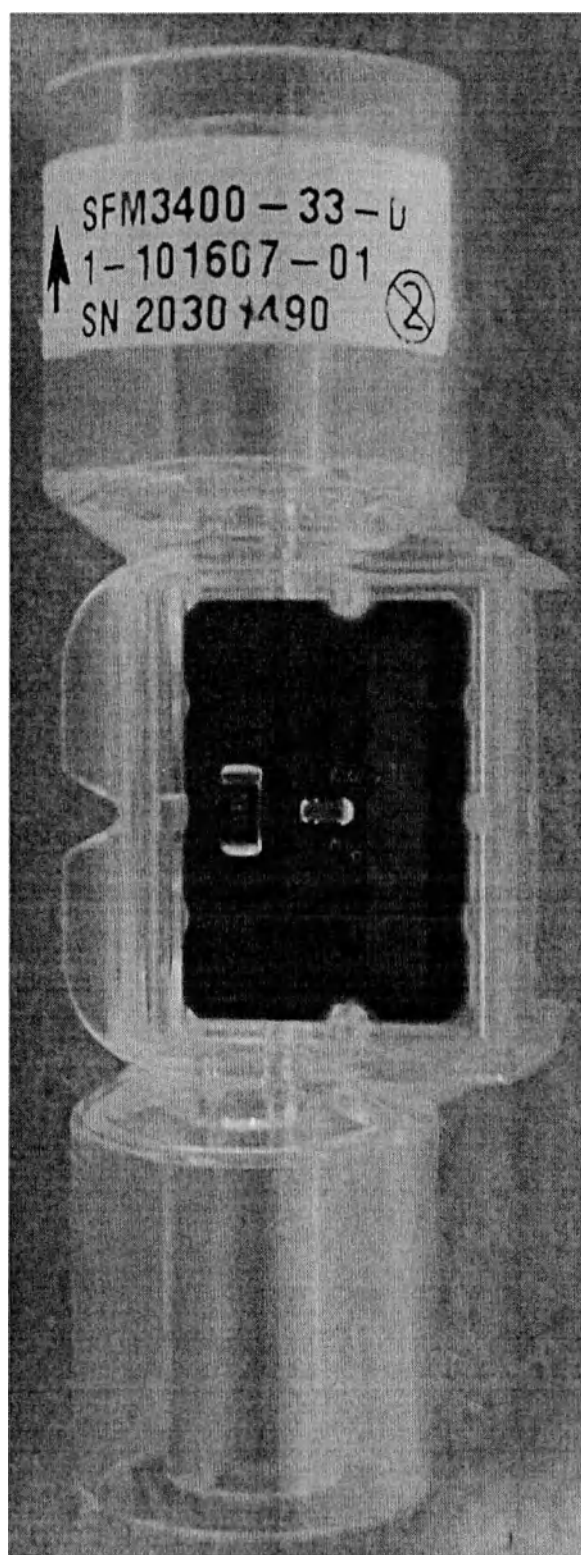


58.3 Датчик потока одноразовый, SFM3400-33-D, Sensirion, Швейцария, в составе Модуля потока внешний, ТЭСМ.236001, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

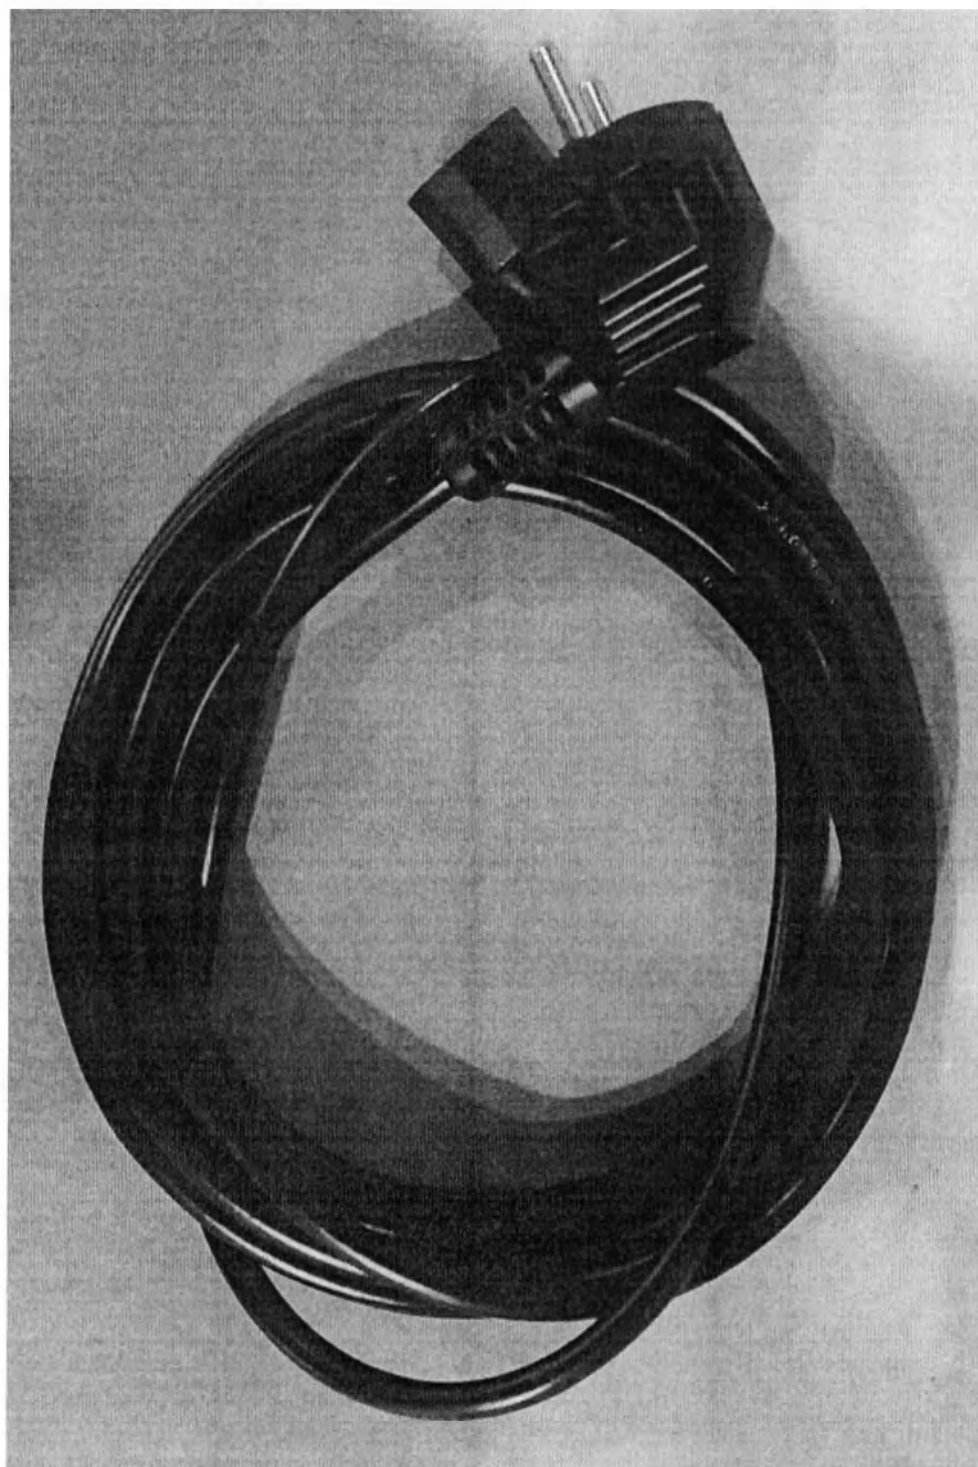


59 Кабель питания (сетевой), ПВХ-ВП 3x1,0 (3 м, разъем питания C13), Производственная компания «Электрическая мануфактура», Россия

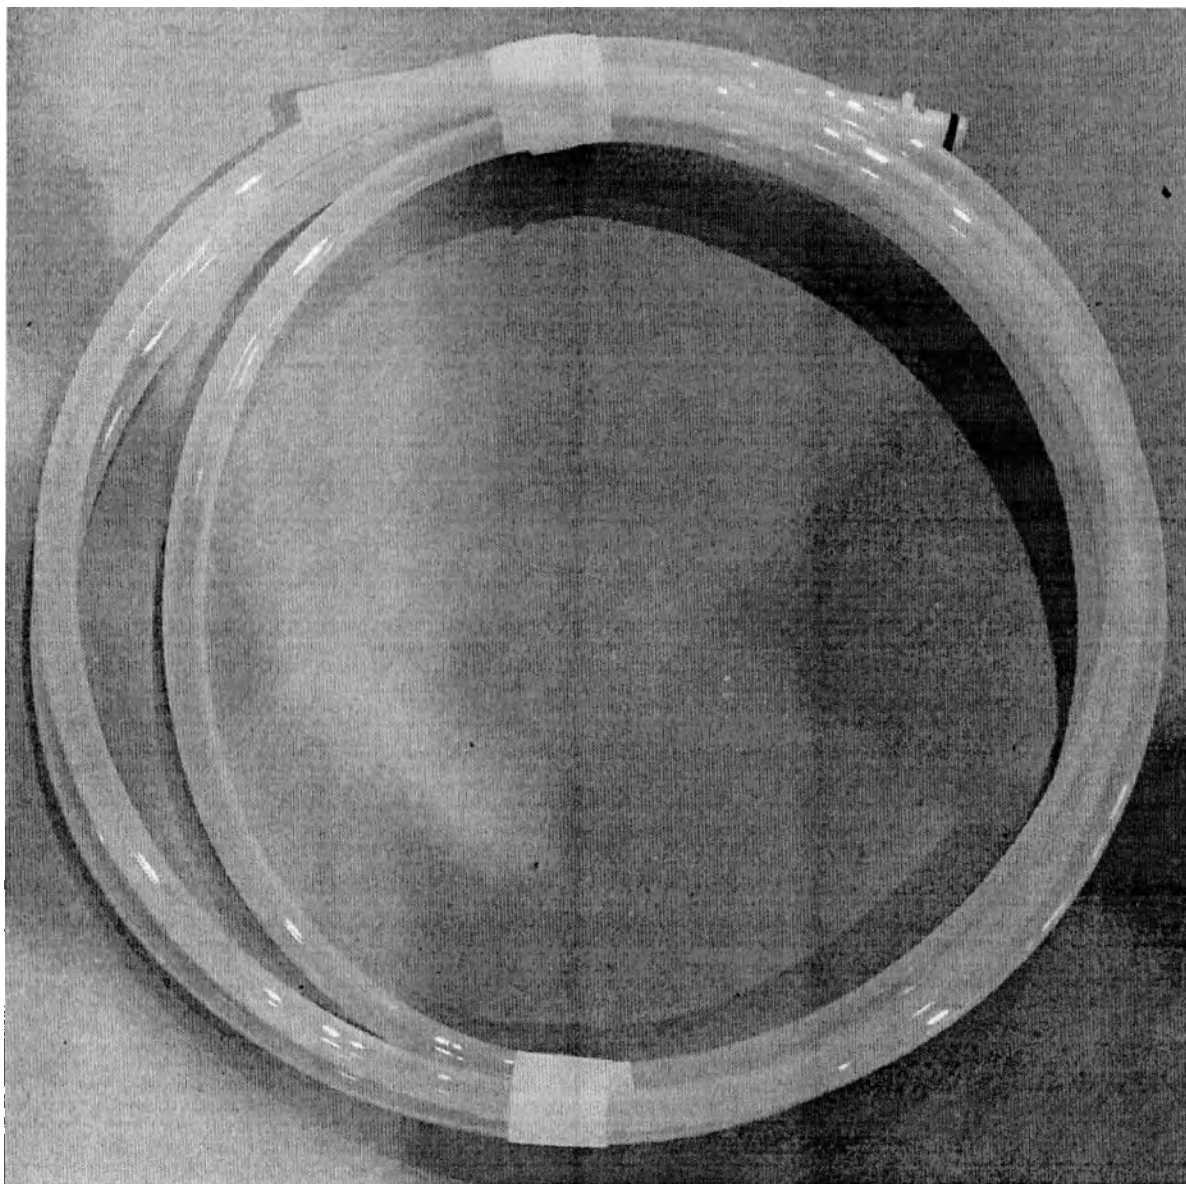


**60 Трубка подключения к кислородному концентратору, ТЕСН.233008, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия**

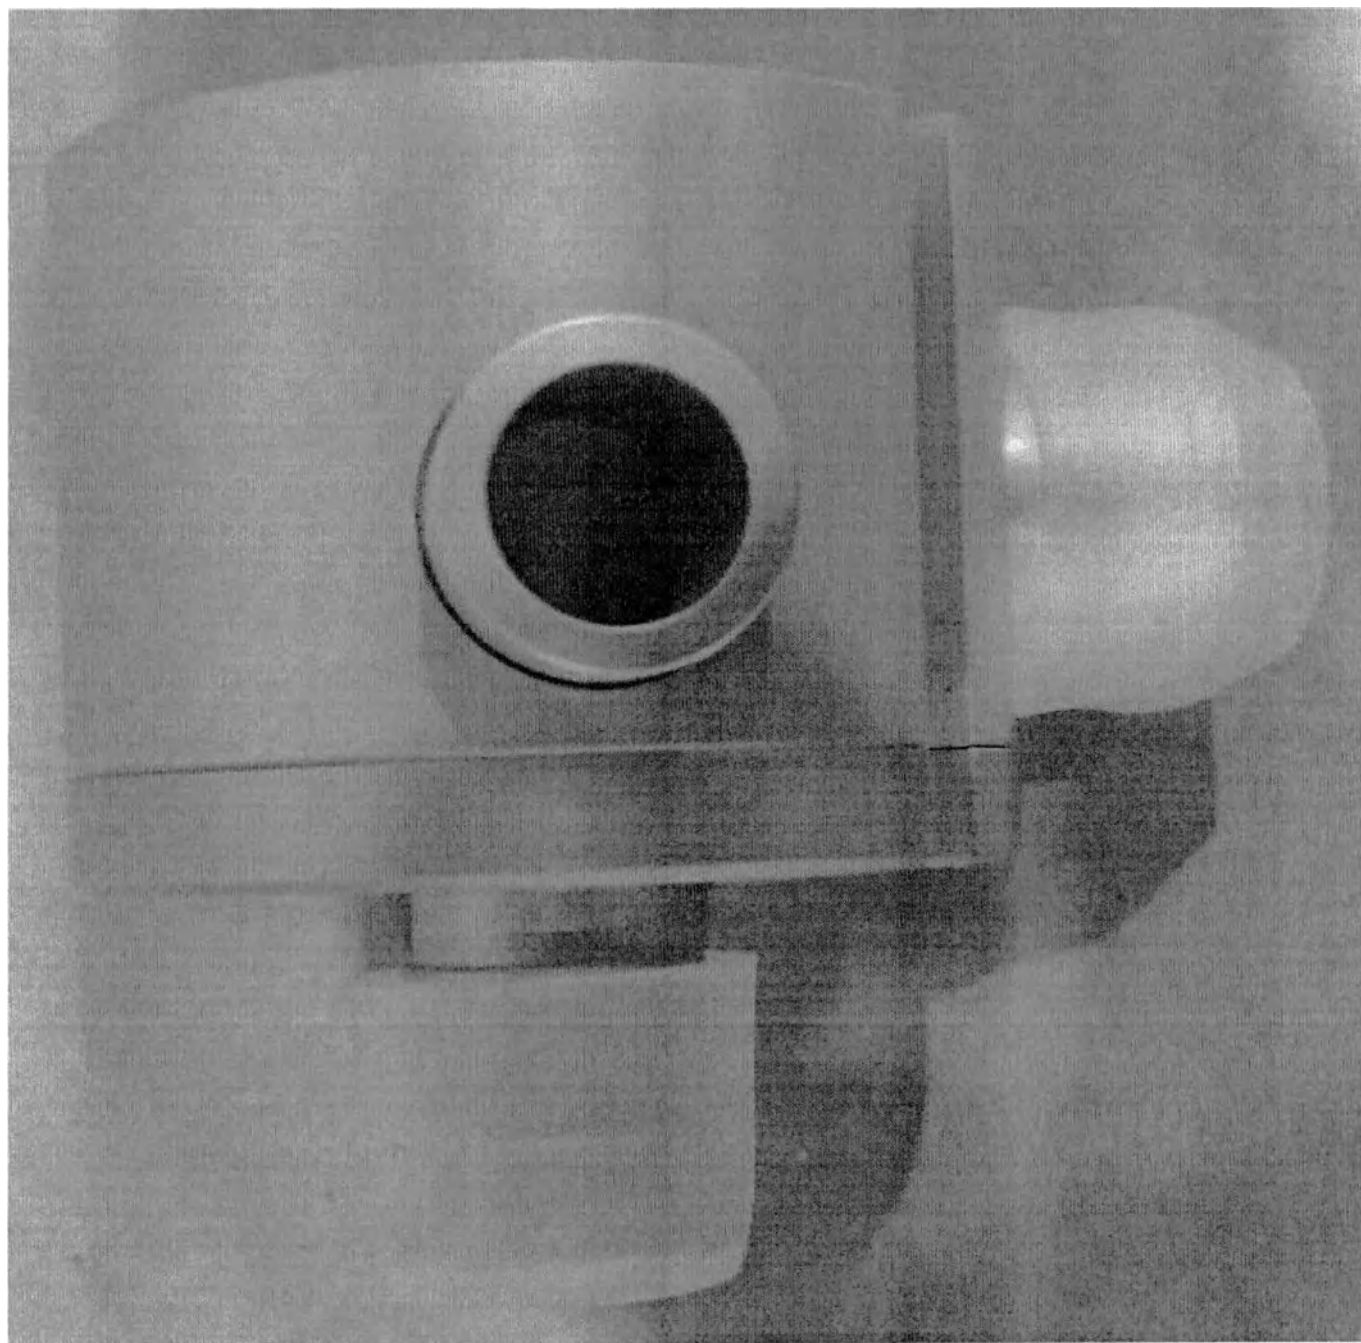


61.1 Клапан выдоха, ТЭСМ.236115, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

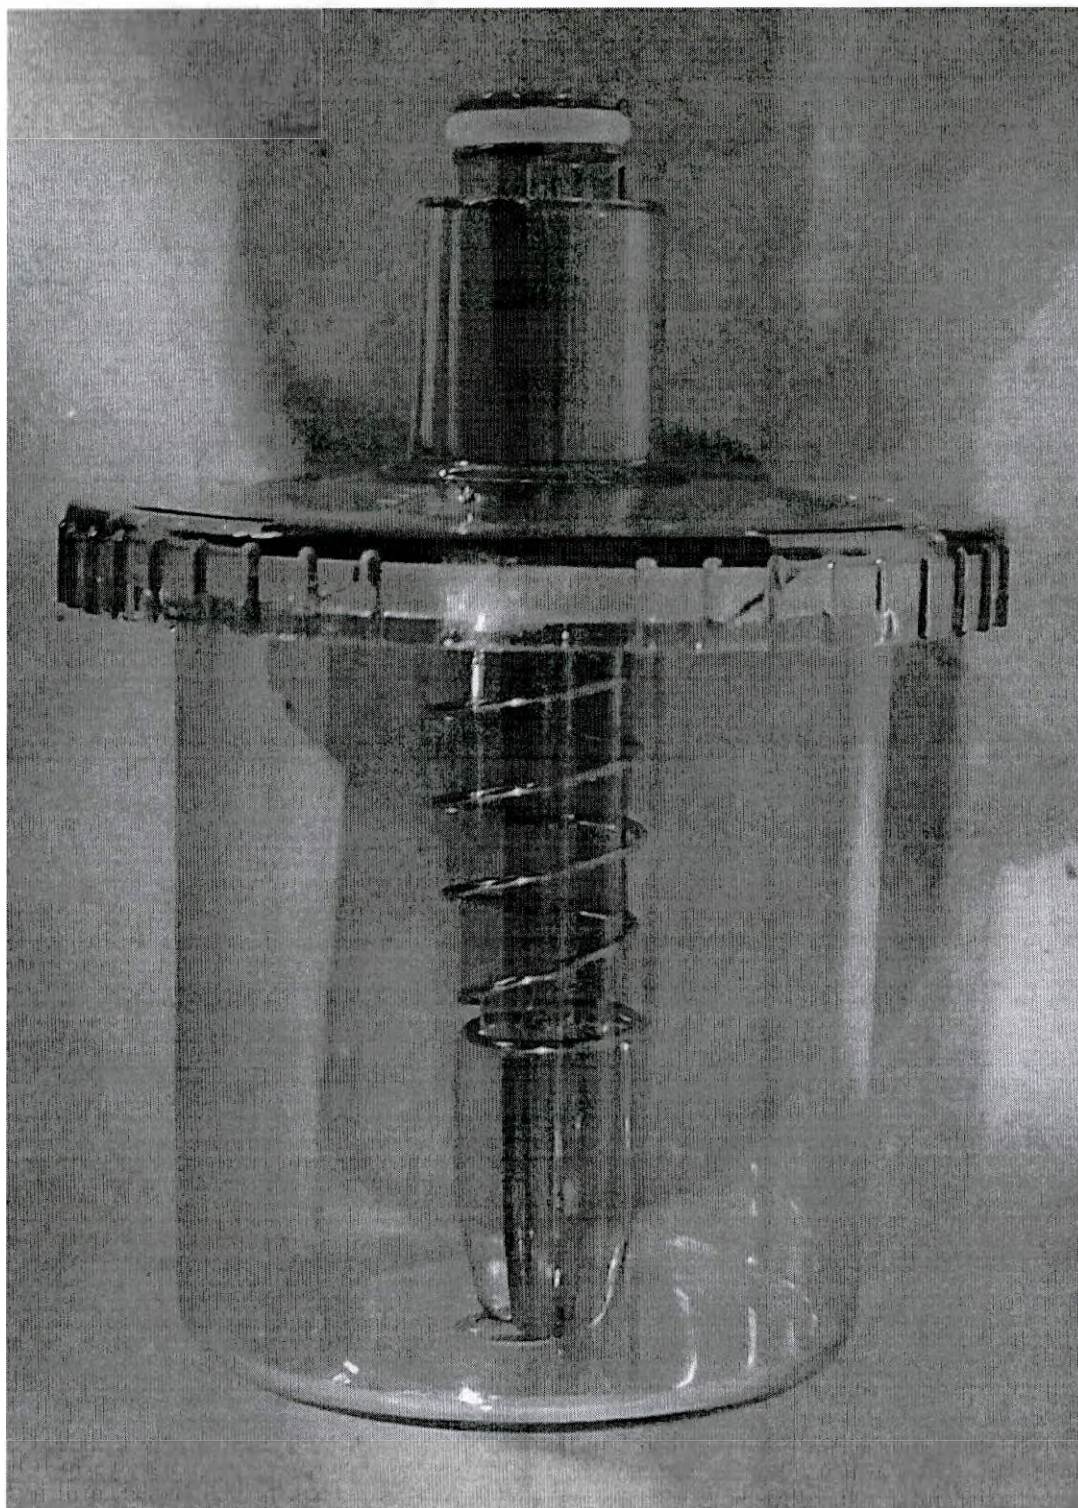


61.2 Влагосборник, ТЭСМ.189626, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

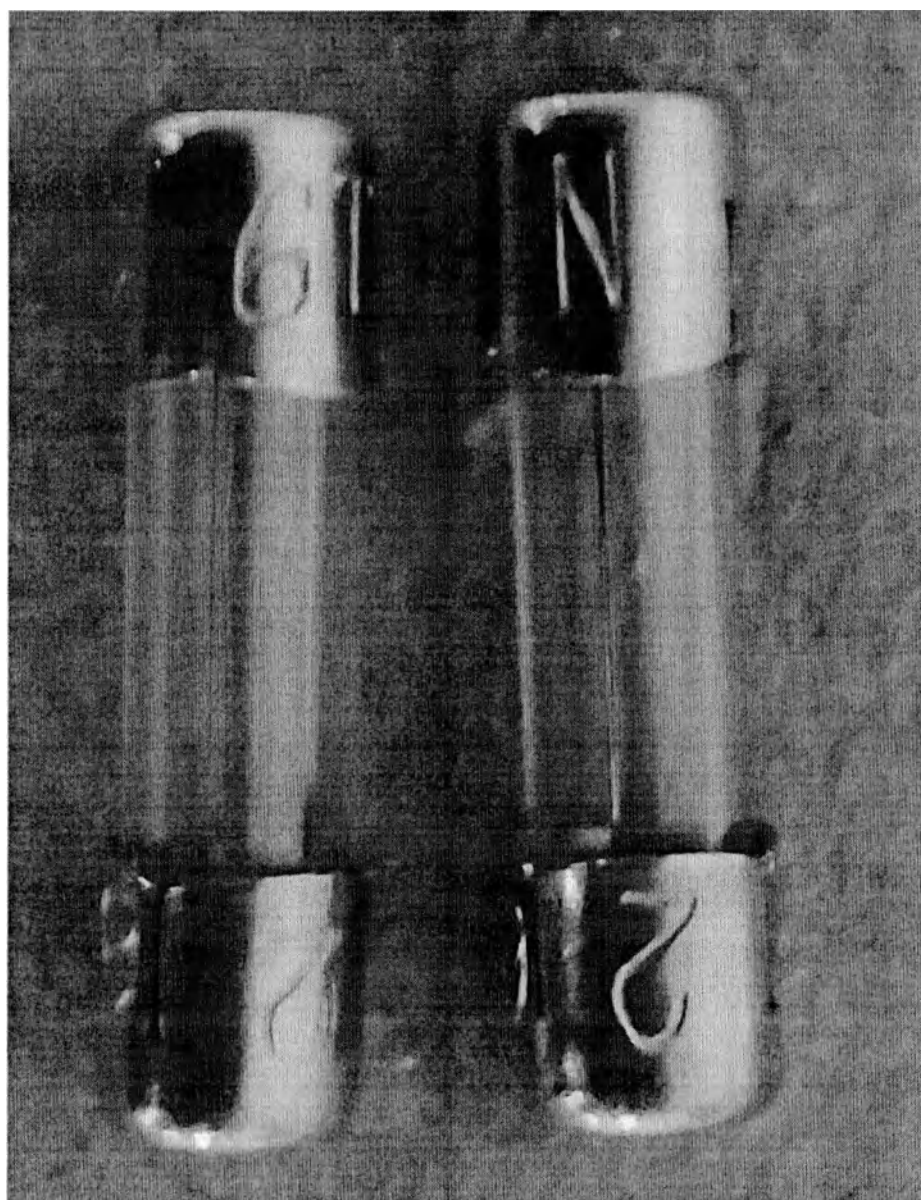


61.3 Предохранитель, ВПТ6-10-2А, АГО 0481.304 ТУ, ОАО «Радиодеталь», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

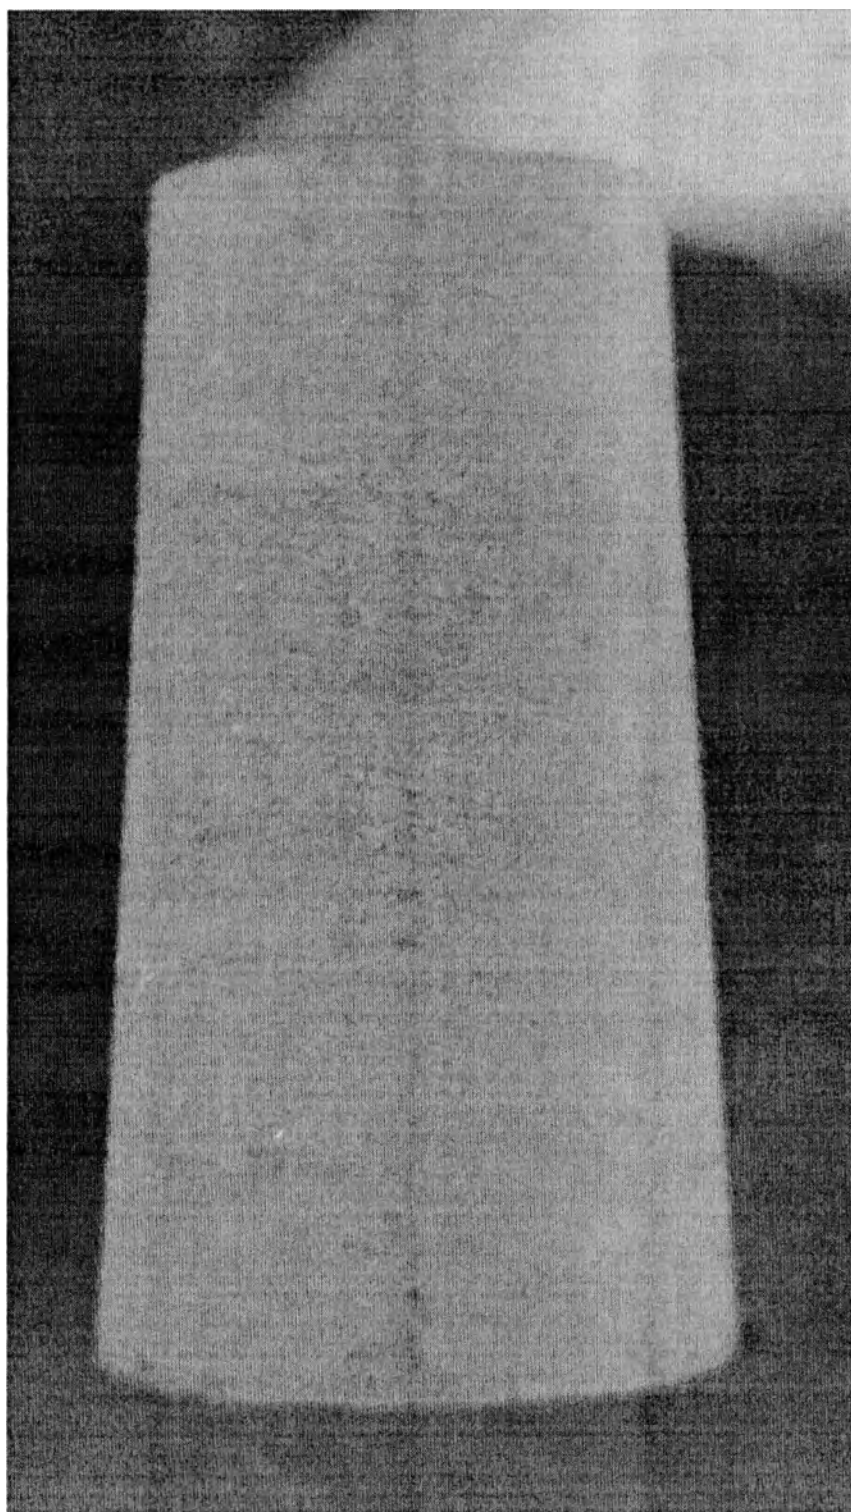


61.4 Фильтрующий элемент, C104-F21/1-OX1, Camozzi Group S.p.A., Италия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

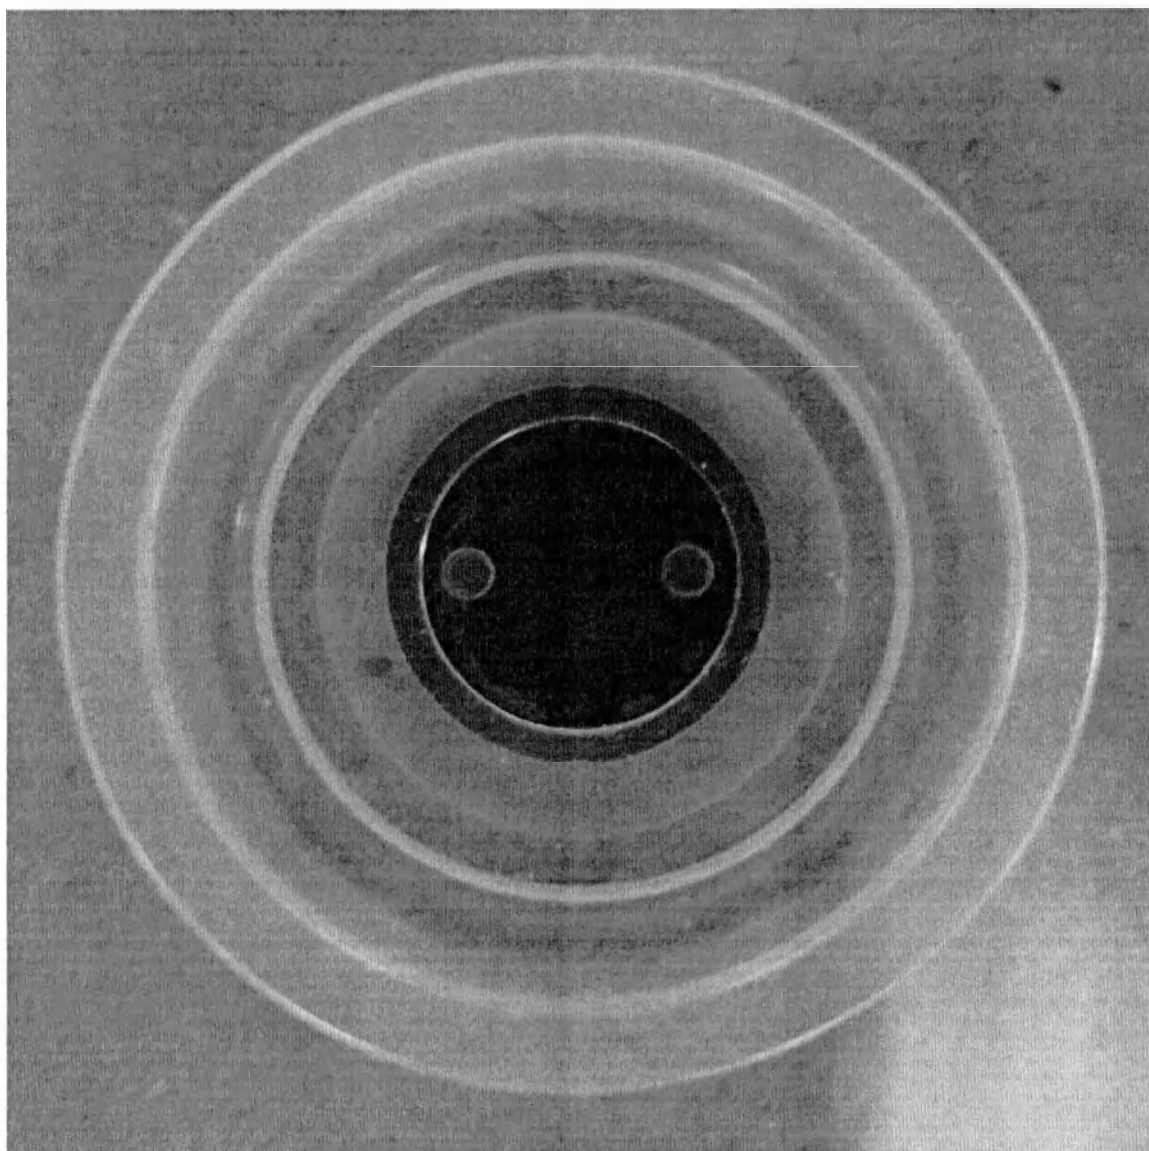

61.5 Мембрана, ТЭСМ.2365010, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия


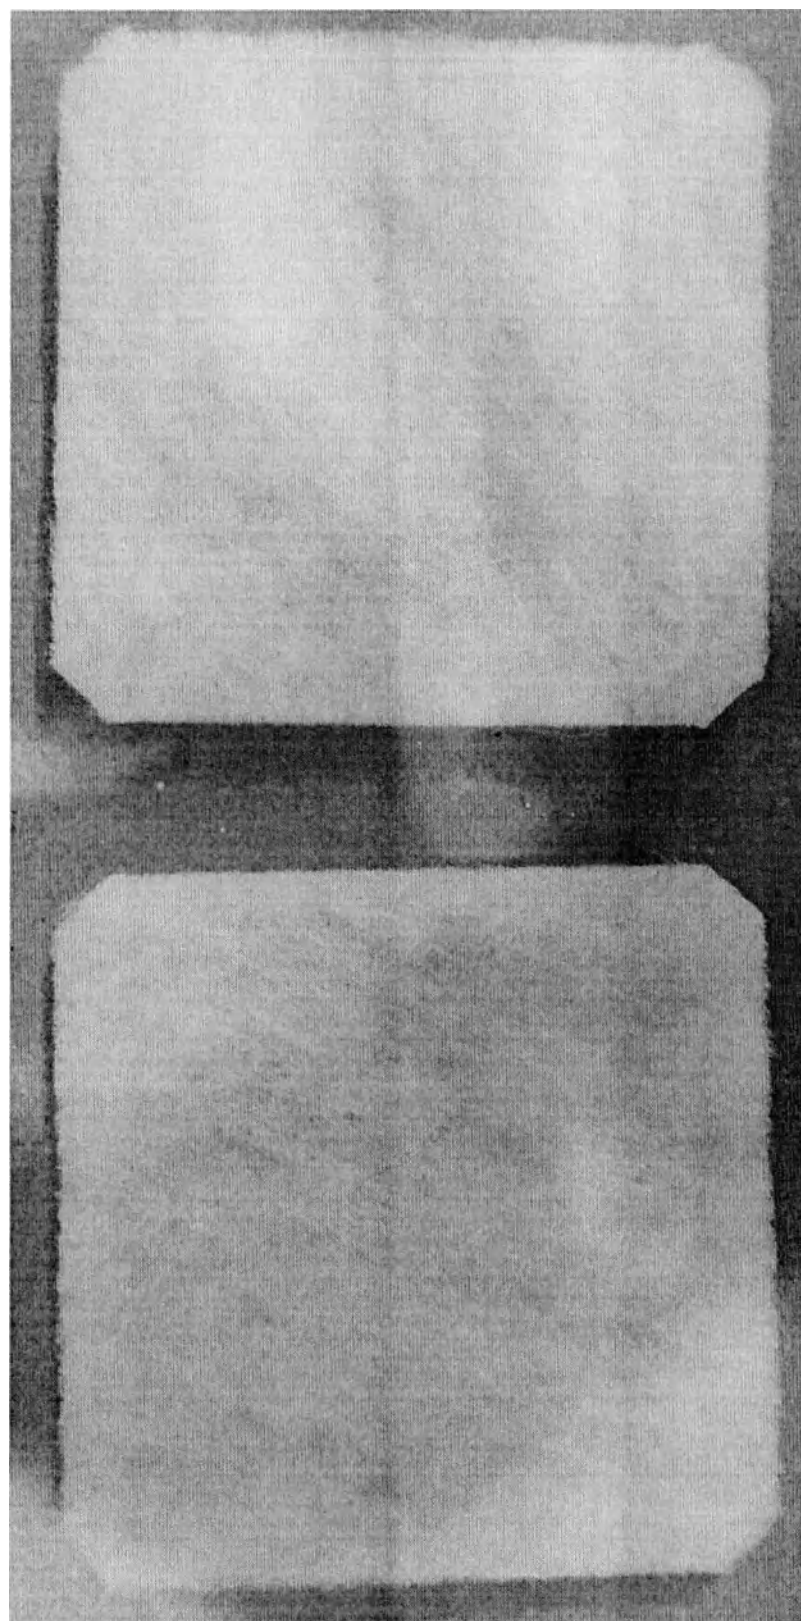


61.6 Фильтр пылевой, ТЭСМ.009926, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия


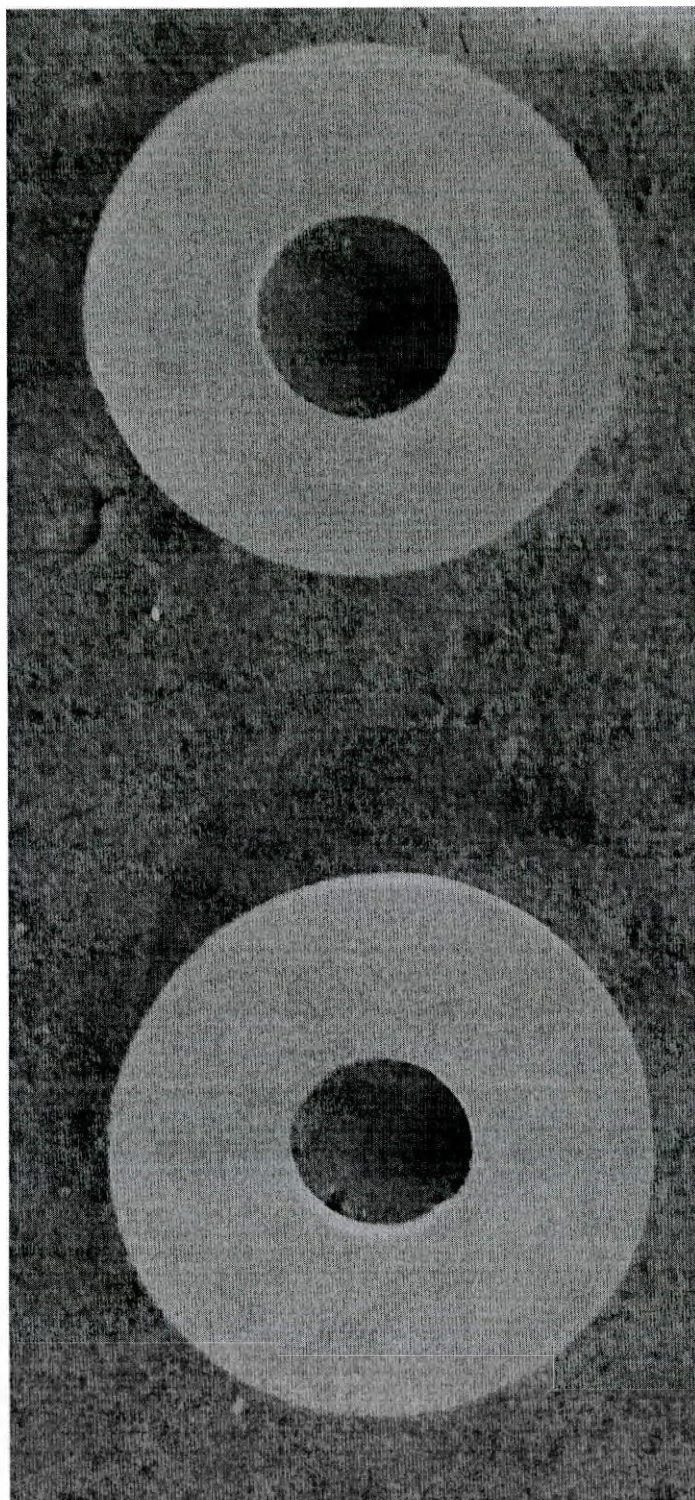


61.7 Кольцо, ТЭСМ.049124, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, в составе Комплекта дополнительного оборудования, ТЭСМ.233006, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия


64 Упаковка транспортная, ТЭСМ.233003

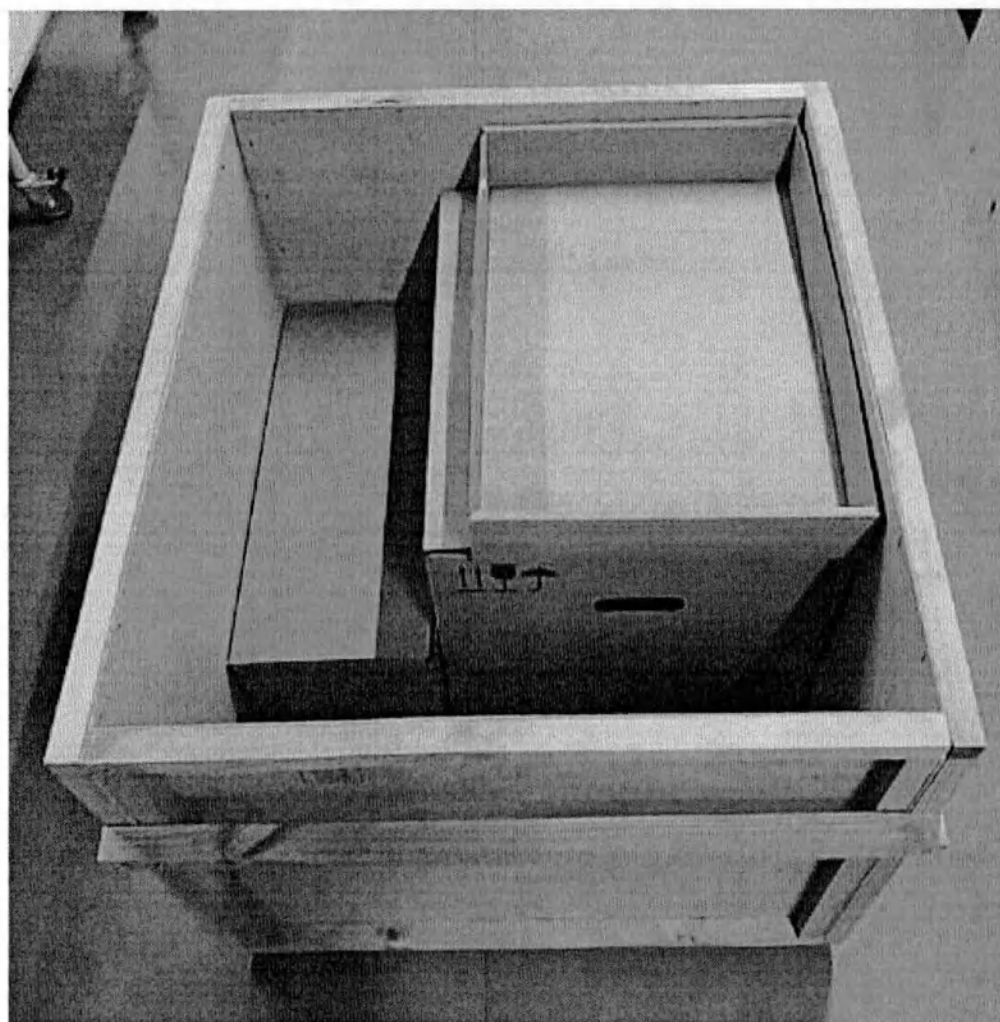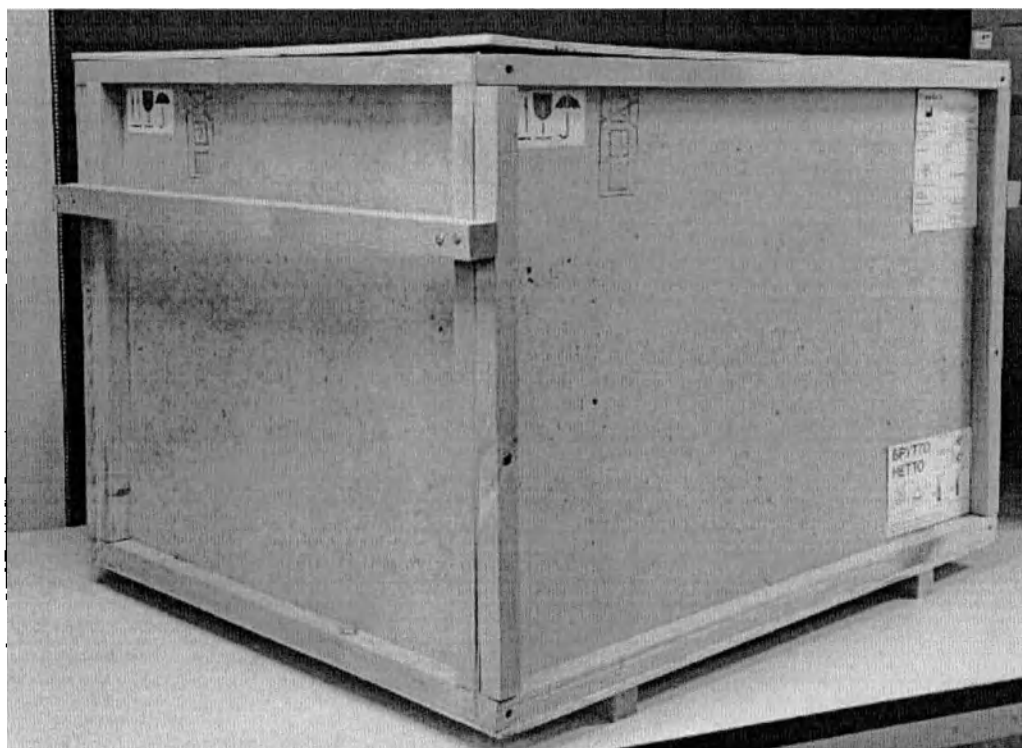

64 . Упаковка транспортная, ТЭСМ.233003-01

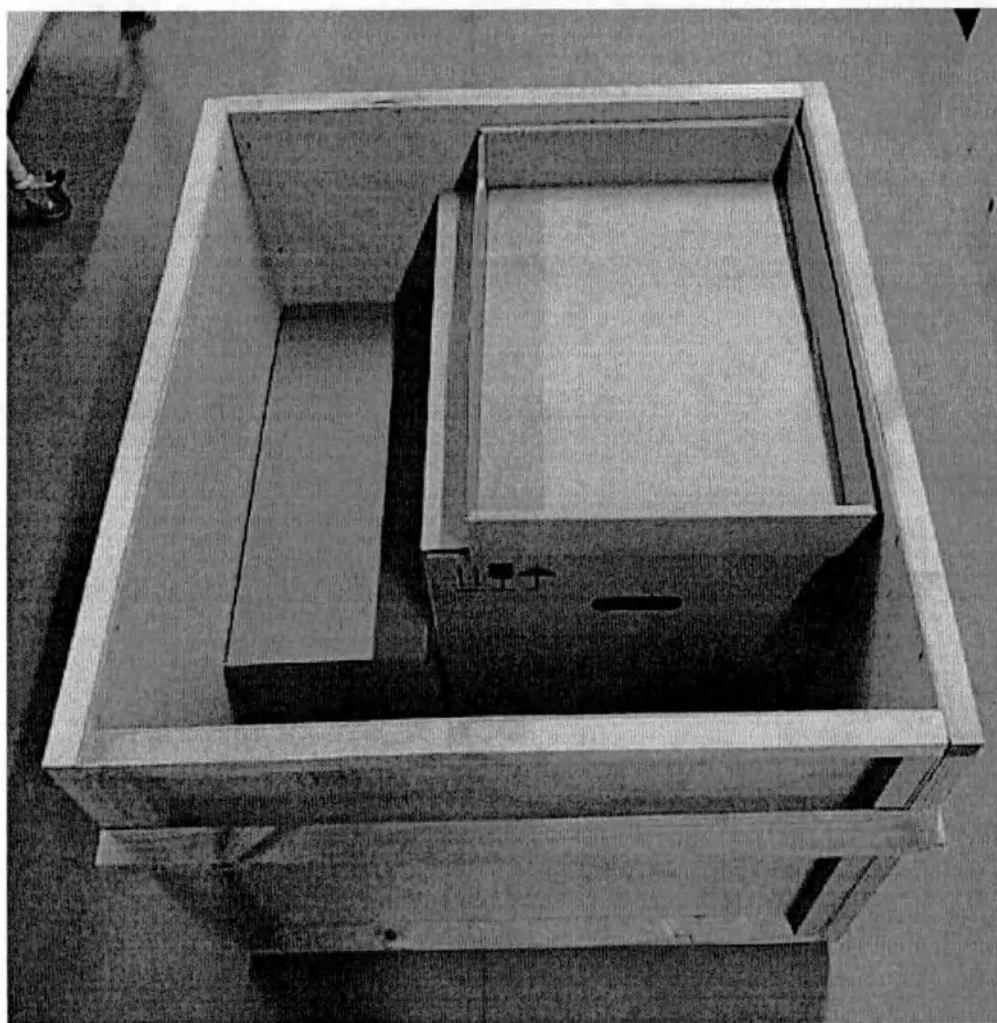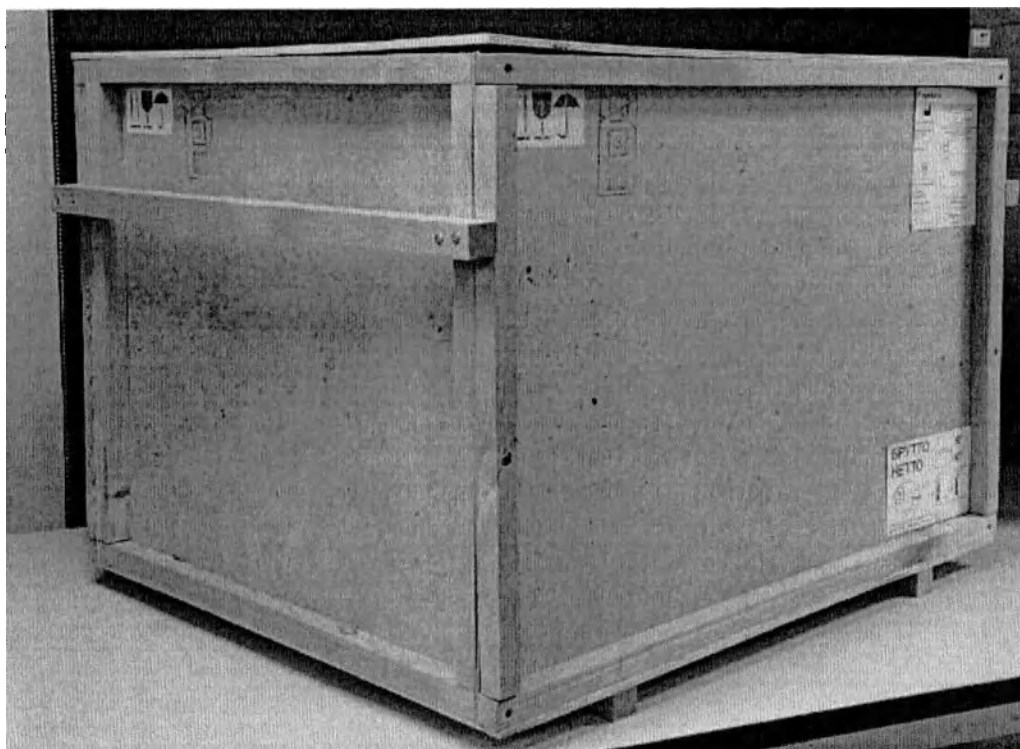

65. Упаковка транспортная ТЭСМ.233007

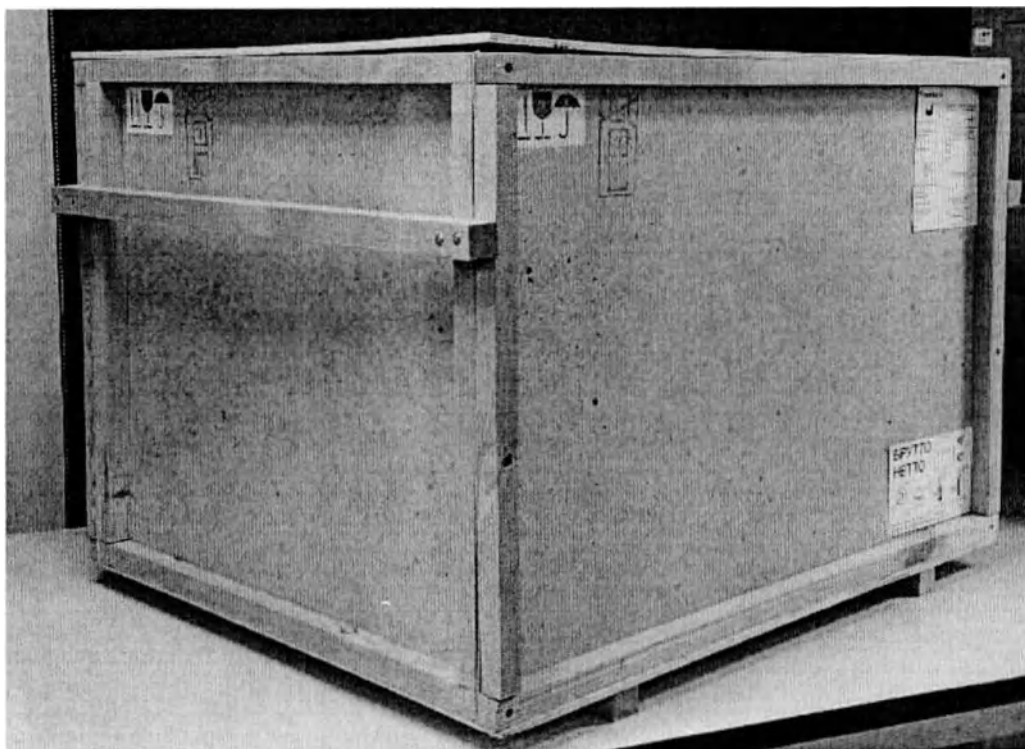

Прошито, пронумеровано,
скреплено по 241 лист
Генеральный директор
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



Н. В. Сафонов

2024г.