

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

ООО «ЭргоПродакшн»

Усейнов Д.В.



30 июня 2023 г.

**НАБОР КРАСИТЕЛЕЙ HISTOSAFE® ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ТУ 20.59.52-078-89079081-2023
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

**Сборник фотографических изображений, данных о
маркировке и упаковке медицинского изделия
для диагностики *in vitro***

Содержание

1. Данные о маркировке и упаковке	4
1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 1. Набор окраски по Грокотту, 100	5
1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор окраски по Ван Гизону – Фуше, 100 тестов	8
1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов	10
1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 4. Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов	13
1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 5. Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3х250 мл	16
1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов	18
1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 7. Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов	21
1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 8. Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов	23
1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 9. Набор окраски по Коссу, 100 тестов	26
1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 10. Набор окраски сириус красный, 100 тестов	29
1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 11. Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов	31
1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 12. Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов	34
1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 13. Набор окраски орсеином, 100 тестов	36
2. Фотографические изображения	38
2.1 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 1. Набор окраски по Грокотту, 100	39
2.2 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор окраски по Ван Гизону – Фуше, 100 тестов	42
2.3 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов	45
2.4 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 4. Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов	48
2.5 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 5. Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3х250 мл	51
2.6 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов	56
2.7 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 7. Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов	59
2.8 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 8. Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов	62
2.9 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 9. Набор	

окраски по Коссу, 100 тестов	65
2.10 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 10. Набор окраски сириус красный, 100 тестов	68
2.11 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 11. Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов	71
2.12 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 12. Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов	74
2.13 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 13. Набор окраски орсеинном, 100 тестов	77

1. Данные о маркировке и упаковке

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ТУ 20.59.52-078-89079081-2023, технической документации, ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 18113-1, ГОСТ Р ИСО 18113-2, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 14192 и предупредительной маркировки согласно п. 4.3 ГОСТ 31340-2022.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 20.59.52-078-89079081-2023, п. 5.4 Маркировка внутренней (первичной) упаковки, п. 5.5 Маркировка внешней (вторичной) упаковки, п. 5.6 Маркировка транспортной упаковки.

1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 1.

Набор окраски по Грокотту, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты хромовой, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор сульфита натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор уротропина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор нитрата серебра 5%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Раствор тетрабората натрия водный, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Ф. Тонер, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Г. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Н. Раствор зеленого спиртовой, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски по Грококту, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



IVD REF HK-GT-AQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C / +8°C

www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
Для профессионального применения.



ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований
по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.

Набор окраски по Грококту, 100 тестов



Состав: Краткая инструкция по применению;

- A. Раствор кислоты хромовой, 30 мл;
- B. Раствор сульфата натрия, 30 мл;
- C. Раствор уротропина, 30 мл;
- D. Раствор нитрата серебра 5%, 30 мл;
- E. Раствор тетрабората натрия водный, 30 мл;
- F. Тонер, 30 мл;
- G. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл;
- H. Раствор зеленого спиртовой, 30 мл.

Внимание!
Не использовать фиксаторы с содержанием солей тяжелых металлов.

Краткая характеристика опасности:
H302+H332: Вредно при проглатывании, при вдыхании; H315+H317+H319: При попадании на кожу может вызвать выраженное раздражение/аллергическую реакцию; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H334: При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию; H335: Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей; H340: Может вызвать генетические дефекты; H350: Может вызывать раковые заболевания; H361: Предполагается, что может отрицательно влиять на способность к деторождению или на нерожденного ребенка; H373: Может повредить органы; H410+H411: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры по предупреждению опасности:
P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания; P264: После работы тщательно вымыть руки; P272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой, снять контактные линзы; P308+P313+P333+P337+P342+P311+P310: При необходимости обратиться к врачу; P391: Ликвидировать проливы; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски по Грококту, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GT-AQ00

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

+2°C / +30°C

При температурах выше + 8°C – до трех суток

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований
по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.

Набор окраски по Грококту, 100 тестов




Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор окраски по Ван Гизону – Фуше, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты трихлоруксусной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор хлорида железа, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски по Ван Гизону - Фуше, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



IVD REF HK-PR-VQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C +25°C







www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
Для профессионального применения.



ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований
по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.

Набор окраски по Ван Гизону - Фуше, 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты трихлоруксусной, 30 мл;
 В. Раствор хлорида железа, 30 мл;
 С. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл.

Внимание!
 Реагент А отличается коррозионной активностью – обращаться с осторожностью.

Краткая характеристика опасности:
 H314+H316+H319: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей; H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры по предупреждению опасности:
 P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту; P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ/волосы: Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть водой; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух; покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P332+P313+P337+P310: При раздражении кожи/глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски по Ван Гизону - Фуше, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PR-VQ00

LOT XXXXXX

MM.GGGT

MM.GGGT

ПУ № XXXXXX

+2°C +30°C



При температурах выше + 25°C – до трех суток

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований
по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.


**Набор окраски по Ван Гизону - Фуше,
100 тестов**

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____


По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор ацетатного буфера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор нитрата серебра 9%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор нитрата серебра в ацетатном буфере, 6 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 6 мл



Д. Раствор желатина, 6 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 6 мл

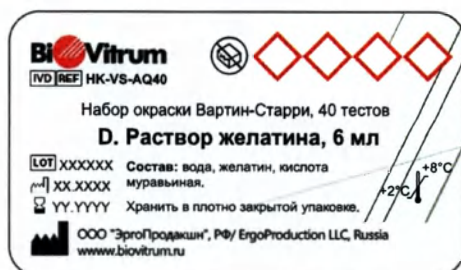


Е. Раствор гидрохинона 0,2%, 5 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 5 мл



Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

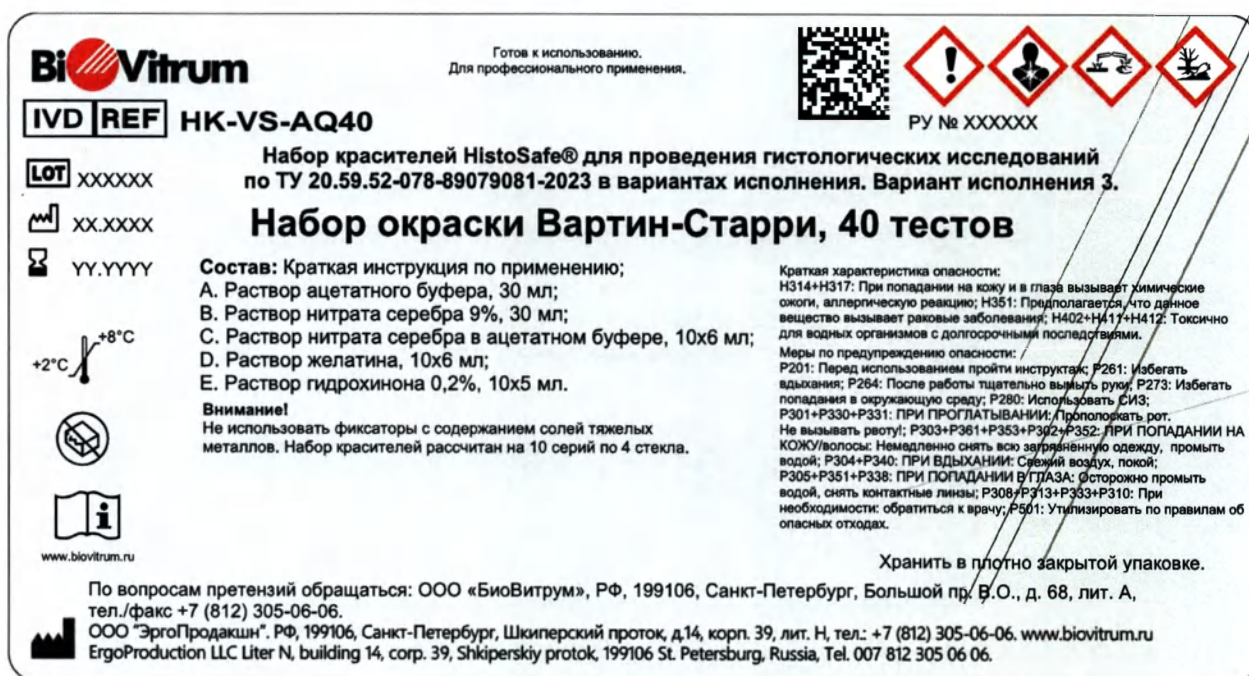

Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-VS-AQ40		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.					
Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов					
LOT	XXXXXX				
	MM.ГГГГ	Кол-во штук:			
	MM.ГГГГ	Масса нетто:			
РУ № XXXXXX		Масса брутто:			
	+30°C +2°C	Масса нетто потребительской упаковки:			
При температурах выше + 8°C – до трех суток					
					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 4.
Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор нитрата серебра 9%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Концентрированный раствор ацетатного буфера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

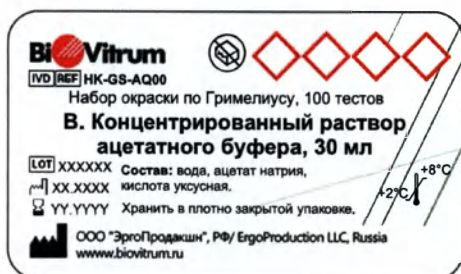


С. Раствор гидрохинона 2%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор натрия сульфита, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

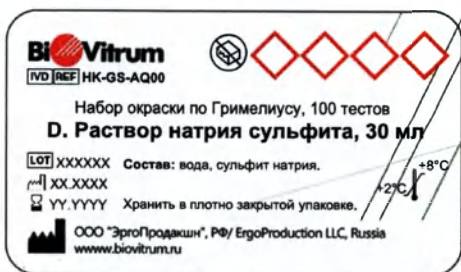

Е. Буферизированный раствор нитрата серебра, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Ф. Восстанавливающий раствор, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Г. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



IVD REF HK-GS-AQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C / +8°C





www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
Для профессионального применения.



ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.

Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор нитрата серебра 9%, 30 мл;
 В. Концентрированный раствор ацетатного буфера, 30 мл;
 С. Раствор гидрохинона 2%, 30 мл;
 Д. Раствор натрия сульфита, 30 мл;
 Е. Буферизированный раствор нитрата серебра, 30 мл;
 F. Восстанавливающий раствор, 30 мл;
 G. Раствор тиосульфата натрия, 2x30 мл.

Внимание!
Не использовать фиксаторы с содержанием солей тяжелых металлов.

Краткая характеристика опасности:
 H317+H314+H319: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H351: Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания; H401+H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры по предупреждению опасности:
 P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания; P264: После работы тщательно вымыть руки; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту; P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть водой; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Срежьте воздух, покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P308+P313: При необходимости: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GS-AQ00

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

+2°C / +30°C

При температурах выше +8°C – до трех суток

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.

Набор окраски по Гримелиусу, 100 тестов






Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____






По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru

1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 5. Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3x250 мл

Первичная упаковка


А. Гематоксилин по Гейденгайну, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл




В. Раствор сульфата железа(III)-аммония, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

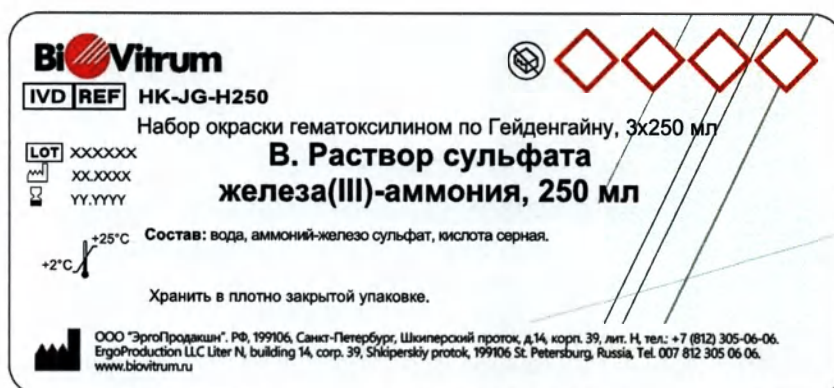

Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

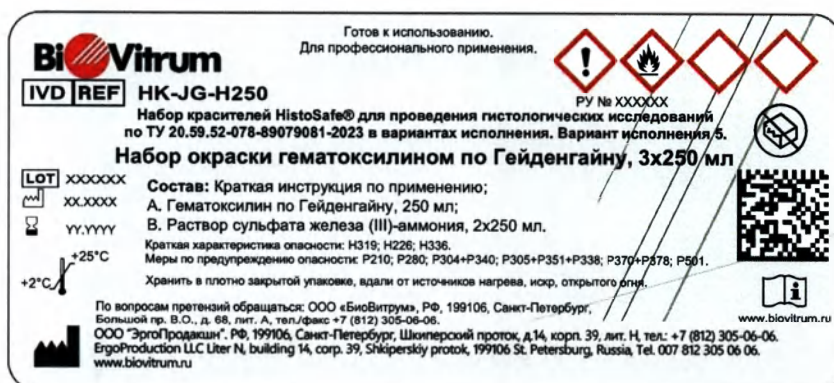

Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3х250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-JG-H250		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.					
LOT	XXXXXX	Набор окраски гематоксилином по Гейденгайну, 3х250 мл			
	MM.ГГГГ	Кол-во штук:	_____		
	MM.ГГГГ	Масса нетто:	_____		
РУ №	XXXXXX	Масса брутто:	_____		
		Масса нетто потребительской упаковки:	_____		
+30°C +2°C При температурах выше +25°C – до трех суток					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 6.

Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты уксусной 12%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор кислоты уксусной 25%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор коллоидного железа, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

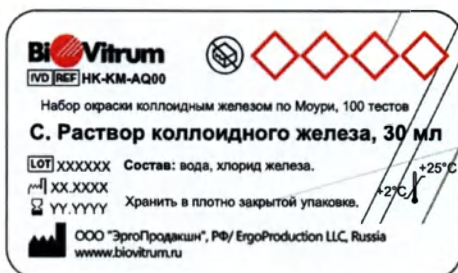

Д. Раствор кислоты уксусной 12%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Е. Раствор кислоты уксусной 12%, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Ф. Раствор ферроцианида калия, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Г. Раствор кислоты соляной, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

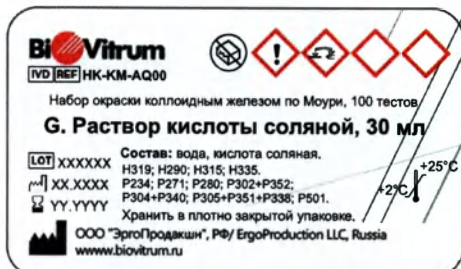


Н. Раствор ядерного красного, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF НК-KM-AQ00		Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.			
LOT XXXXXX		Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов			
 XX.XXXX  YY.YYYY  +25°  		Состав: Краткая инструкция по применению; А. Раствор кислоты уксусной 12%, 30 мл; В. Раствор кислоты уксусной 25%, 30 мл; С. Раствор коллоидного железа, 30 мл; D. Раствор кислоты уксусной 12%, 2x30 мл; E. Раствор кислоты уксусной 12%, 2x30 мл; F. Раствор ферроцианида калия, 30 мл; G. Раствор кислоты соляной, 30 мл; H. Раствор ядерного красного, 30 мл. Внимание! Не использовать фиксаторы с содержанием солей тяжелых металлов.			
www.biovitrum.ru		Краткая характеристика опасности: H314+H315+H319: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P234: Держать только в оригинальной упаковке; P271: Использовать в хорошо вентилируемом помещении; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту; P302+P352+P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ/волосы: Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть водой; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
		Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF НК-KM-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.		Набор окраски коллоидным железом по Моури, 100 тестов		
LOT XXXXXX		Кол-во штук: _____		
 MM.ГГГГ		Масса нетто: _____		
 MM.ГГГГ		Масса брутто: _____		
РУ № xxxxxx		Масса нетто потребительской упаковки: _____		
 +30°C При температурах выше +25°C – до трех суток				
				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 7.

Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор ацетата натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Спиртовой раствор роданина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Гематоксилин Майера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



IVD REF HK-BV-AQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°

+2°C





www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
Для профессионального применения.



ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.

Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор ацетата натрия, 2х30 мл;
 В. Спиртовой раствор роданина, 30 мл;
 С. Гематоксилин Майера, 30 мл.

Внимание!
 Метод рассчитан на одновременную окраску 1 – 4 срезов.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Краткая характеристика опасности:
 H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
 P210: Беречь от источников огня. Не курить.
 P280: Использовать СИЗ; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-BV-AQ00

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № xxxxxx

+30°C

+2°C

При температурах выше + 25°C – до трех суток

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.

Набор окраски для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru










1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 8. Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Азокармин по Гейденгайну, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Спиртовой раствор анилина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Спиртовой раствор кислоты, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты 3%, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Раствор полихромный по Маллори, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

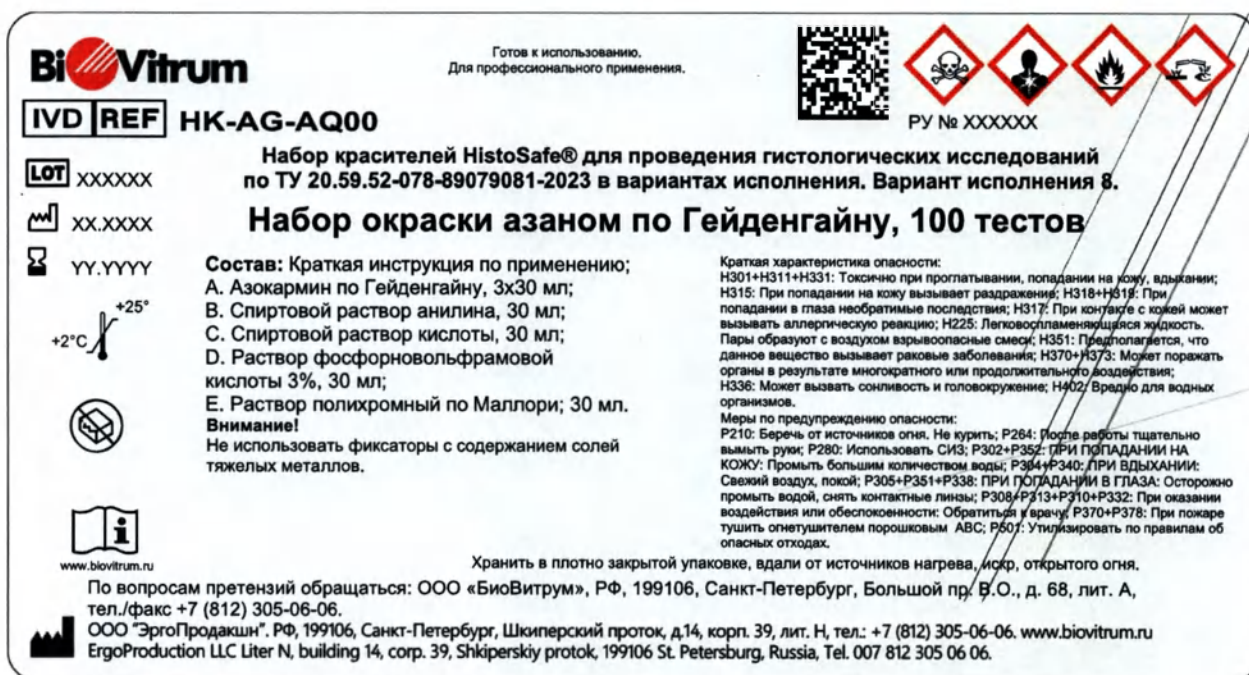

Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

MD REF HK-AG-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079061-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8. Набор окраски азаном по Гейденгайну, 100 тестов					
LOT	XXXXXX				
	MM.ГГГГ	Кол-во штук:			
	MM.ГГГГ	Масса нетто:			
РУ № XXXXX		Масса брутто:			
 При температурах выше +25°C – до трех суток		Масса нетто потребительской упаковки:			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 9.

Набор окраски по Коссу, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор карбоната лития, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

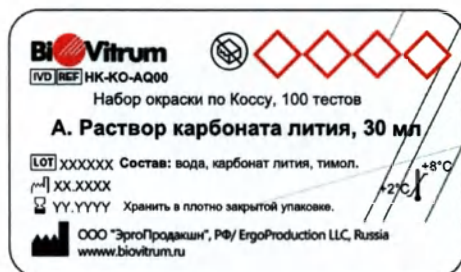

В. Раствор нитрата серебра 5%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор формалина 16%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Раствор ядерного красного, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски по Коссу, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

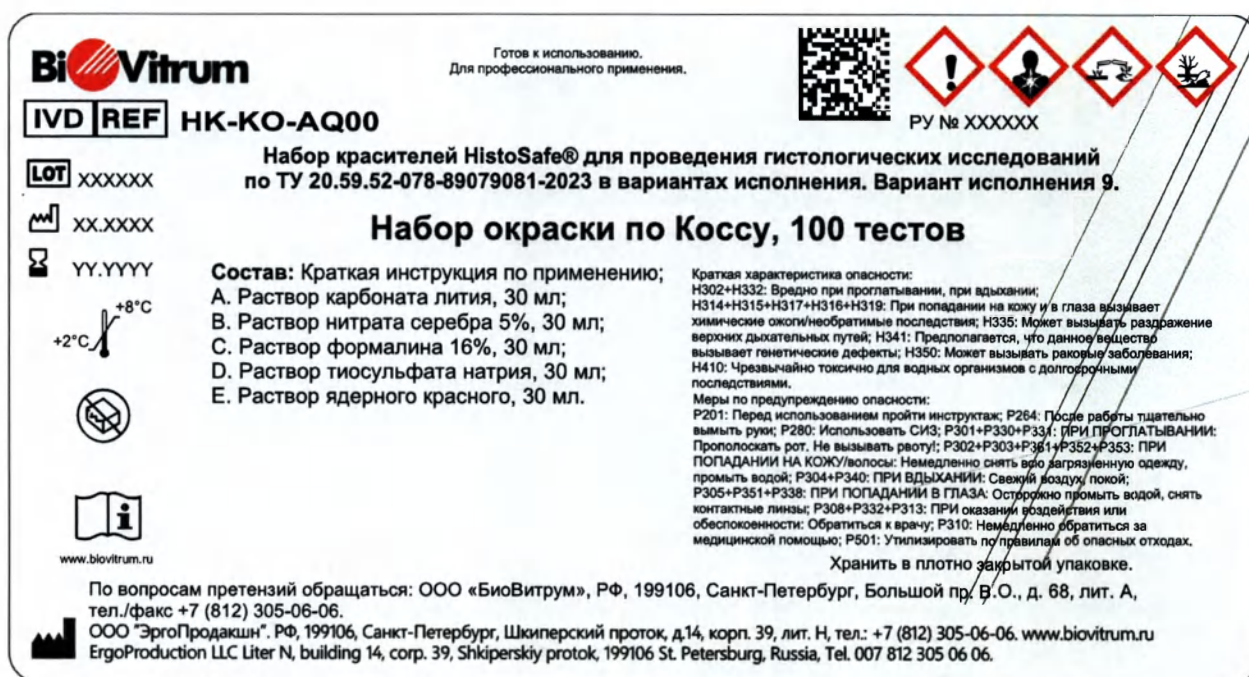

Набор окраски по Коссу, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-KO-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.					
LOT	xxxxxx	Набор окраски по Коссу, 100 тестов			
	MM.ГГГГ	Кол-во штук:			
	MM.ГГГГ	Масса нетто:			
РУ № xxxxxx		Масса брутто:			
	+30°C +2°C	Масса нетто потребительской упаковки:			
При температурах выше +6°C – до трех суток					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 10.

Набор окраски сириус красный, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор сириуса красного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор гидрофосфата натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

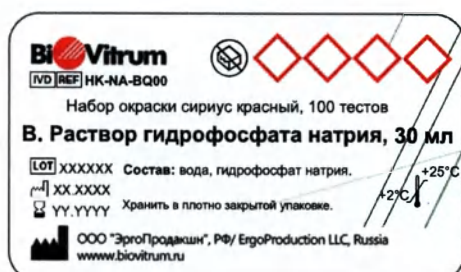

С. Гематоксилин Майера, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски сириус красный, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF HK-NA-BQ00		ПУ № XXXXXX			
LOT XXXXXX		Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.			
 XX.XXXX		Набор окраски сириус красный, 100 тестов			
 YY.YYYY					
 +25° +2°C		Состав: Краткая инструкция по применению; А. Раствор сириуса красного, 30 мл; В. Раствор гидрофосфата натрия, 2х30 мл; С. Гематоксилин Майера, 30 мл.			
		Хранить в плотно закрытой упаковке.			
					
www.biovitrum.ru		По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

Набор окраски сириус красный, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NA-BQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.				
LOT XXXXXX		Набор окраски сириус красный, 100 тестов		
 MM.ГГГГ	Кол-во штук:	 		
 MM.ГГГГ	Масса нетто:			
ПУ № XXXXXX	Масса брутто:			
 +30°C +2°C При температурах выше + 25°C – до трех суток	Масса нетто потребительской упаковки:			
				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				


1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 11.

Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

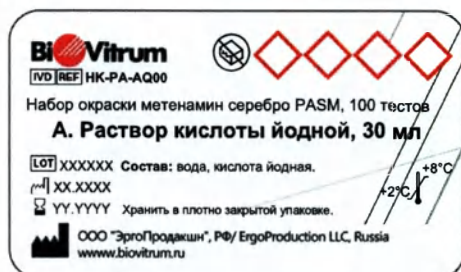

В. Раствор нитрата серебра 1,8%, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор гексаметилентетрамина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор тетрабората натрия водный, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Тонер, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Ф. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

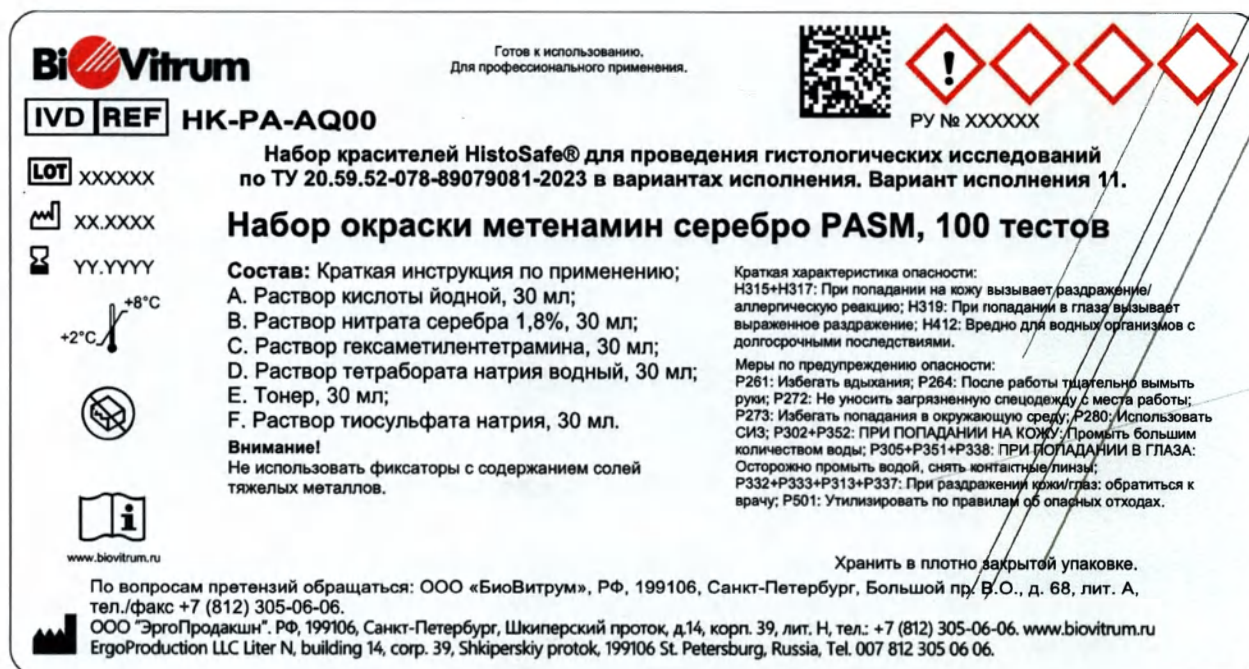

Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF НК-РА-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-076-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.					
LOT	XXXXXX	Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов			
	MM.ГГГГ	Кол-во штук:			
	MM.ГГГГ	Масса нетто:			
РУ №	XXXXXX	Масса брутто:			
	+30°C +2°C	Масса нетто потребительской упаковки:			
При температурах выше +6°C – до трех суток					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 385-06-06. www.biovitrum.ru					

1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 12.
Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор перманганата калия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор кислоты серной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

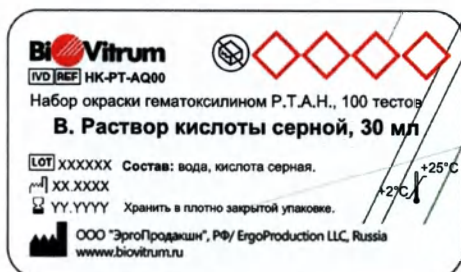

С. Раствор кислоты щавелевой, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Р.Т.А.Н. по Маллори, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF HK-PT-AQ00		РУ № XXXXXX			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.		Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов			
Состав: Краткая инструкция по применению; А. Раствор перманганата калия, 30 мл; В. Раствор кислоты серной, 30 мл; С. Раствор кислоты щавелевой, 30 мл; Д. Р.Т.А.Н. по Маллори, 3х30 мл.		Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи/глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.		Хранить в плотно закрытой упаковке.			

Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PT-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.		Набор окраски гематоксилином Р.Т.А.Н., 100 тестов		
LOT XXXXXX	Кол-во штук: _____			
MM.ГГГГ	Масса нетто: _____			
РУ № XXXXXX	Масса брутто: _____			
MM.ГГГГ	Масса нетто потребительской упаковки: _____			
При температурах выше +25°C – до трех суток				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				


1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 13.

Набор окраски орсеином, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл

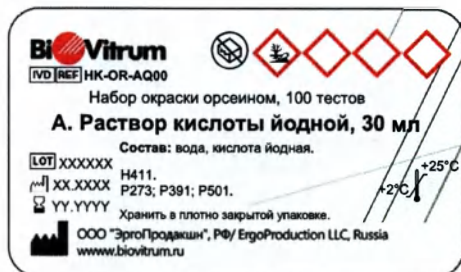

В. Спиртовой раствор для влажной камеры, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор орсеина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Спиртовой раствор кислоты соляной 0,04%, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски орсеином, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF HK-OR-AQ00		PU № XXXXXX			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.					
Набор окраски орсеином, 100 тестов					
Состав: Краткая инструкция по применению; А. Раствор кислоты йодной, 30 мл; В. Спиртовой раствор для влажной камеры, 2х30 мл; С. Раствор орсеина, 30 мл; D. Спиртовой раствор кислоты соляной 0,04%, 30 мл.		Краткая характеристика опасности: H301+H311+H331: Токсично при проглатывании, попадании на кожу, вдыхании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225+H226: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H370: Поражает органы; H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Использовать СИЗ; P301/P310/ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться к врачу; P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды; P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой, снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P391: Ликвидировать проливы; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
		Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.					

Набор окраски орсеином, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-OR-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.				
Набор окраски орсеином, 100 тестов				
LOT XXXXXX	Кол-во штук: _____			
 MM.ГГГГ	Масса нетто: _____			
 MM.ГГГГ	Масса брутто: _____			
PU № xxxxxx	Масса нетто потребительской упаковки: _____			
				
При температурах выше + 25°C – до трех суток				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н., Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

2. Фотографические изображения

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 20.59.52-078-89079081-2023. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 20.59.52-078-89079081-2023 п. 6.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки.

Фото 1. Образец внешнего вида первичной упаковки

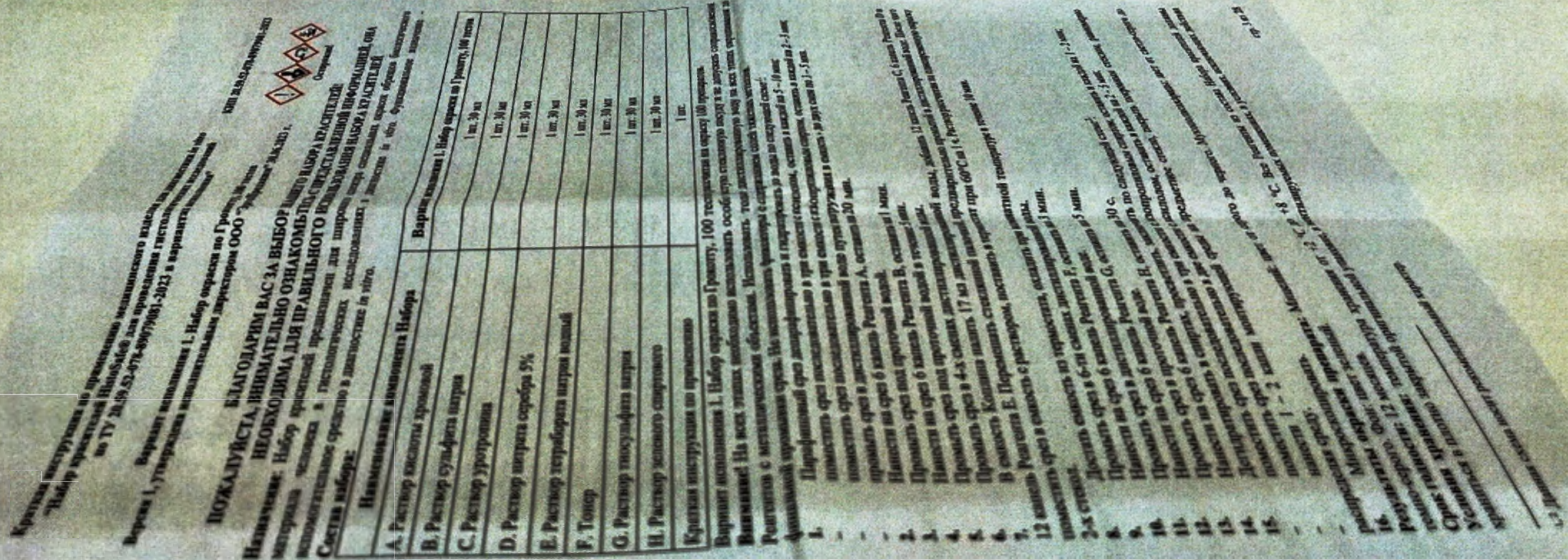


Фото 2. Общий вид первичной упаковки



Фото 3. Образец внешнего вида вторичной упаковки

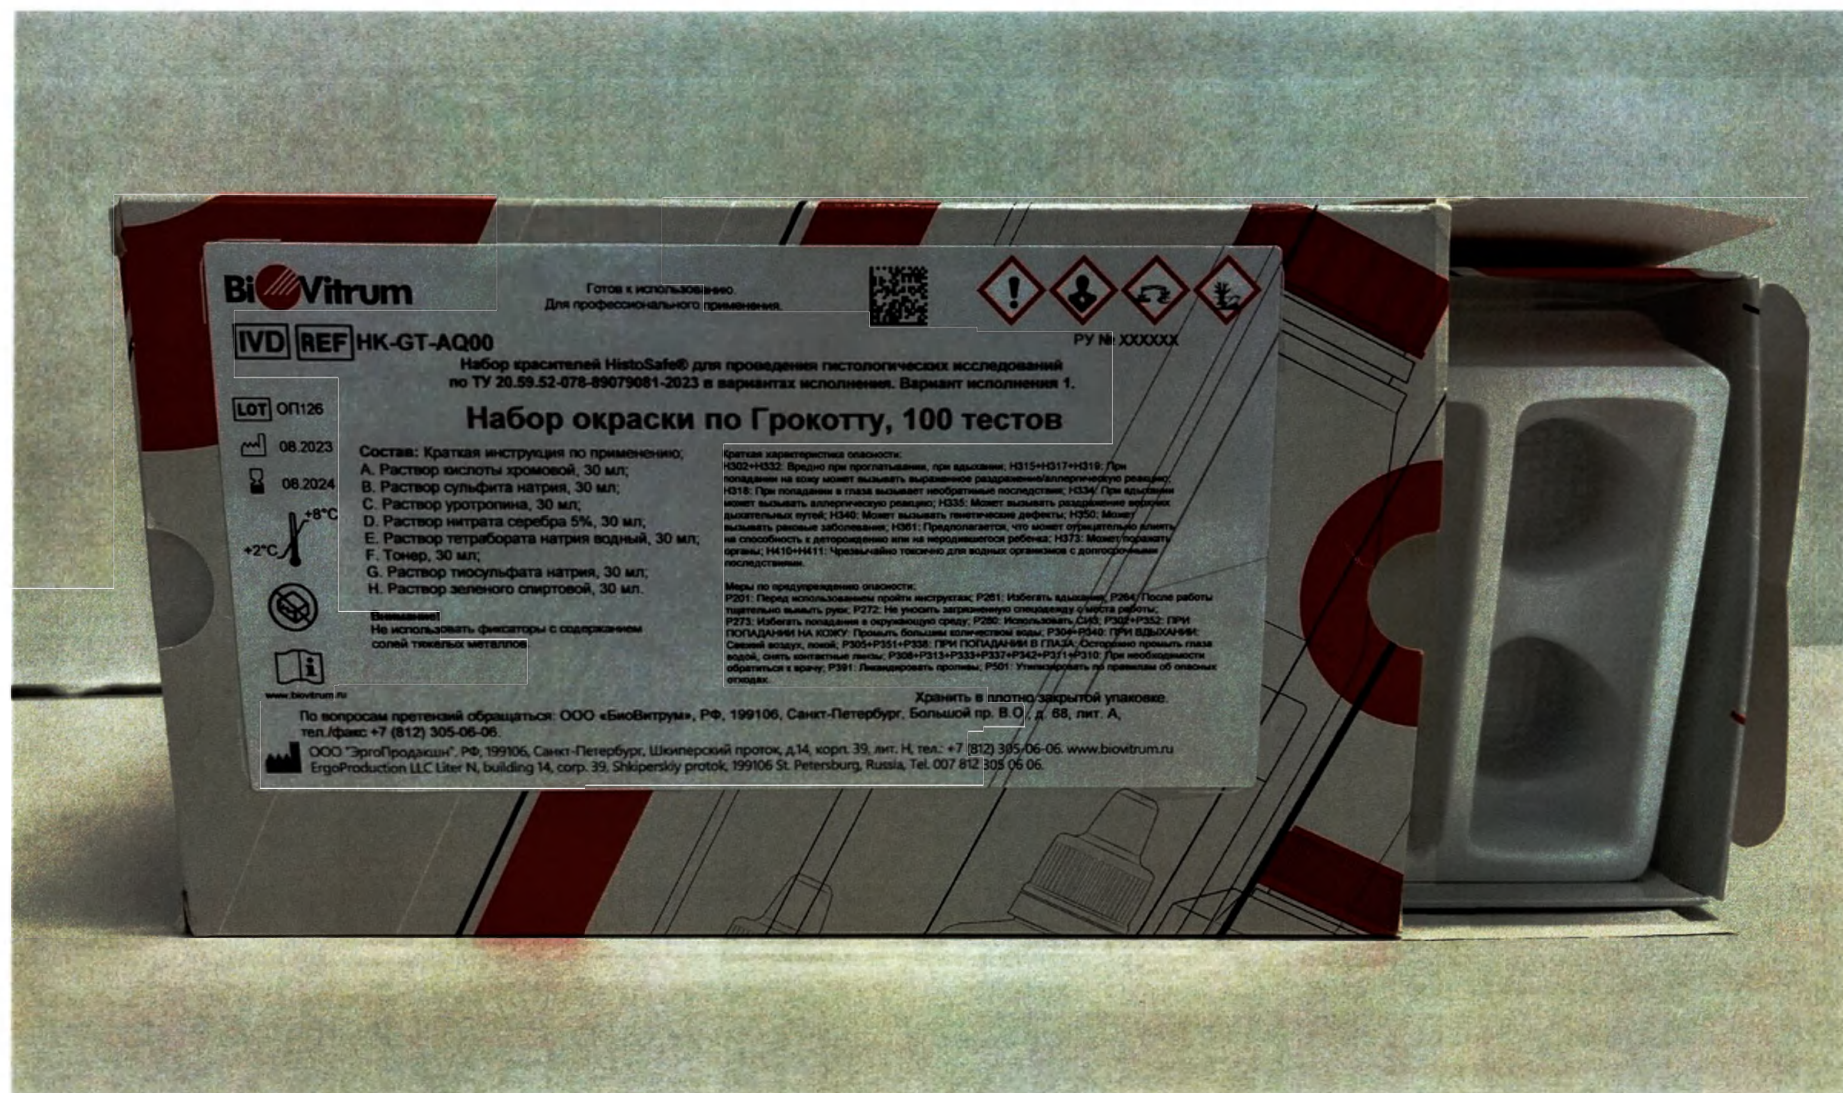


Фото 5. Общий вид первичной упаковки



Фото 6. Образец внешнего вида вторичной упаковки



2.3 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор окраски Вартин-Старри, 40 тестов

Фото 7. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 8. Общий вид первичной упаковки



Фото 9. Образец внешнего вида вторичной упаковки



Фото 10. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 11. Общий вид первичной упаковки



Фото 12. Образец внешнего вида вторичной упаковки

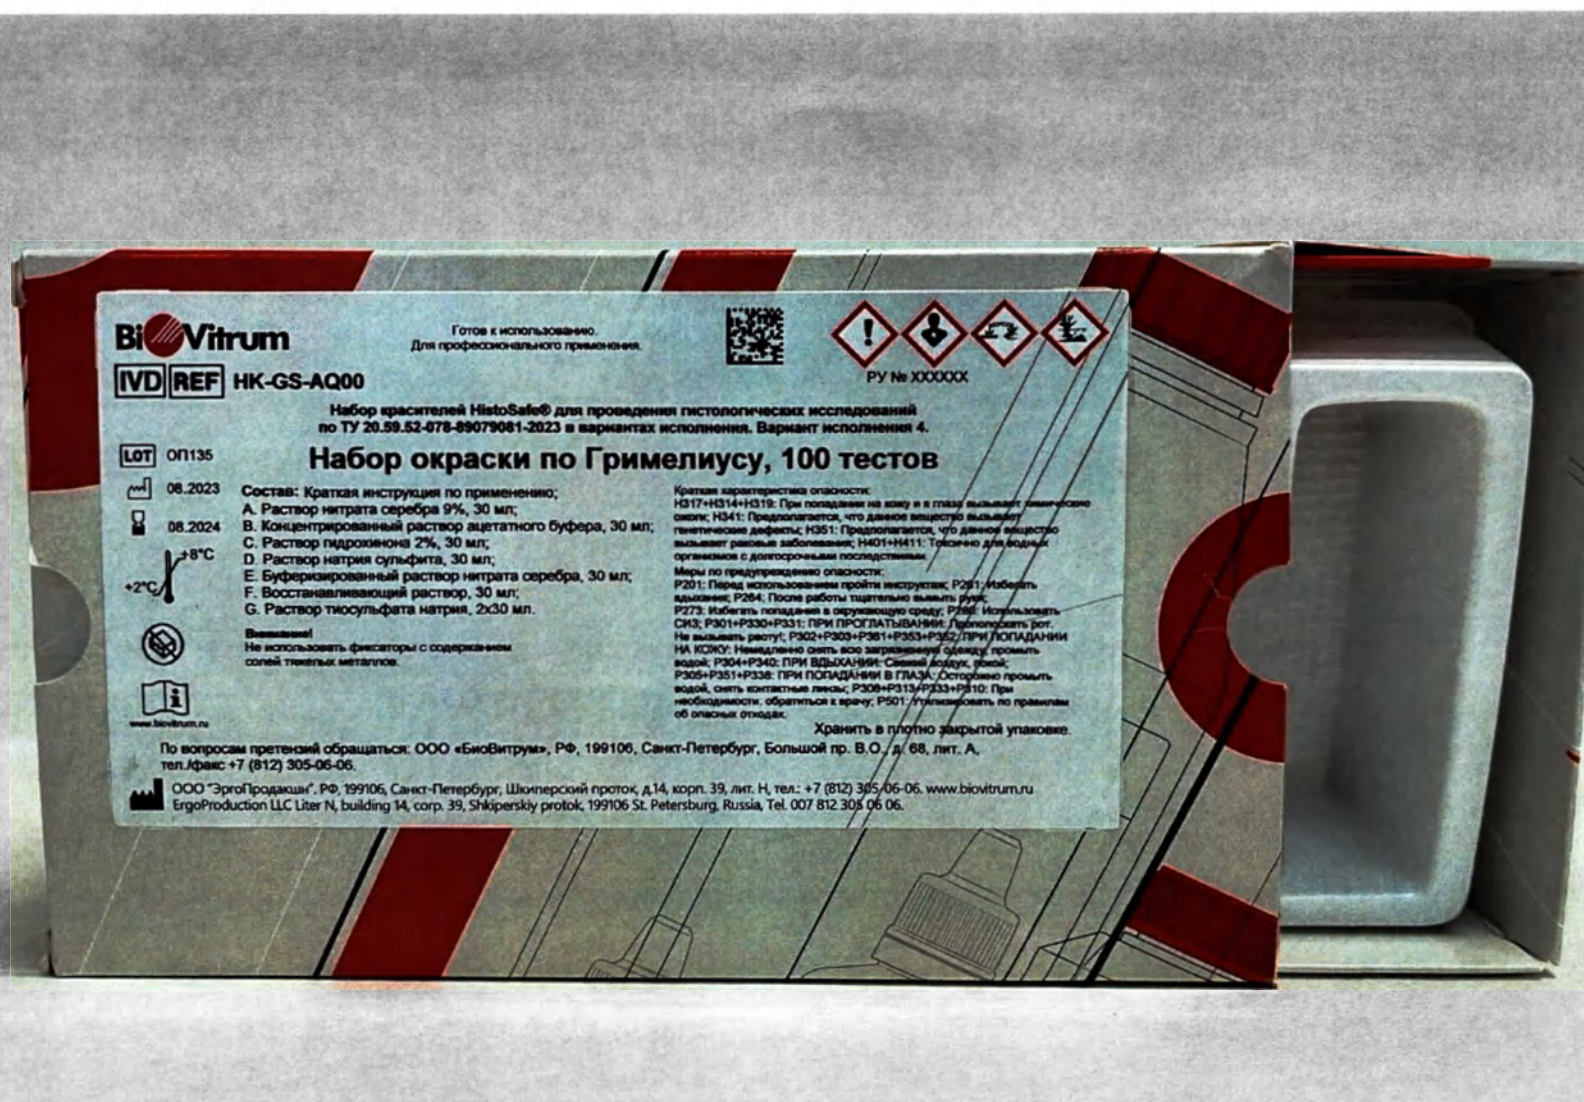


Фото 13. Образец внешнего вида первичной упаковки, вариант упаковки 1



Фото 14. Общий вид первичной упаковки, вариант упаковки 1



Фото 15. Образец внешнего вида первичной упаковки, вариант упаковки 2

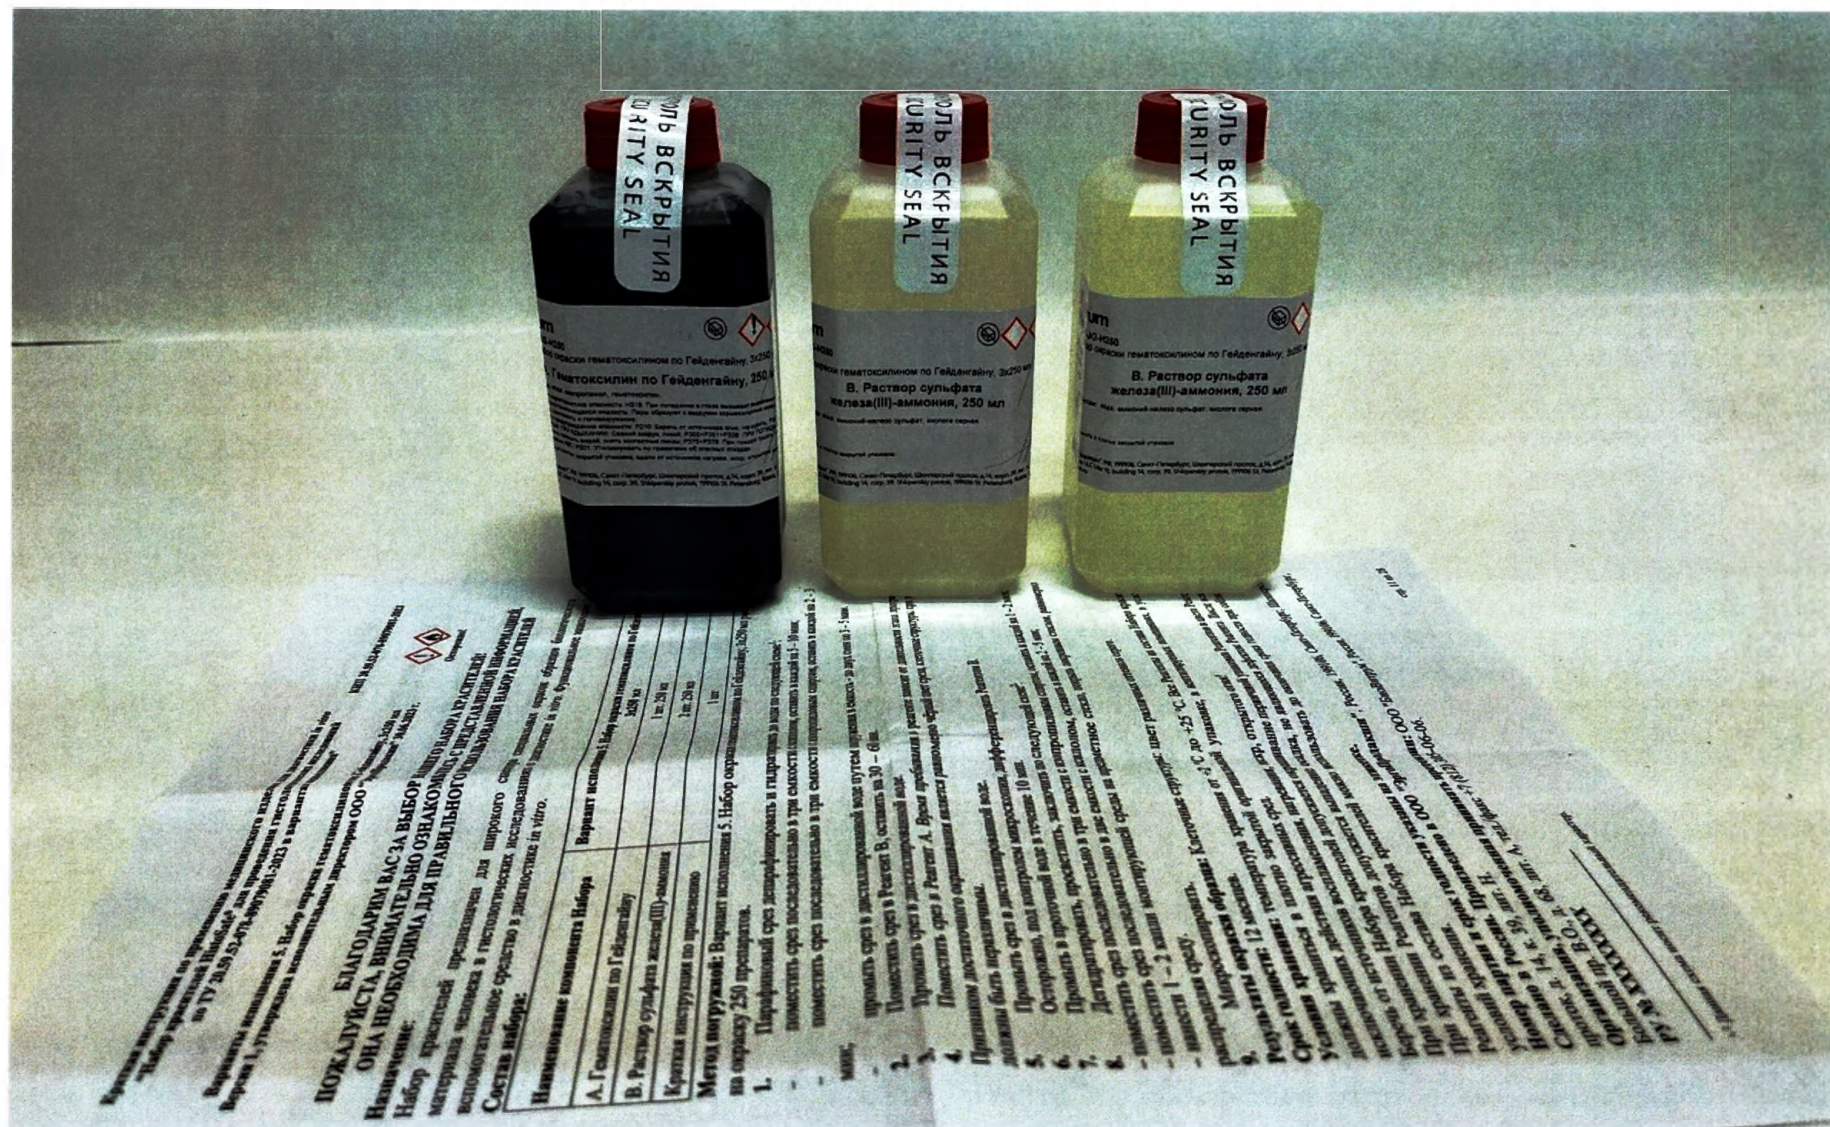


Фото 16. Общий вид первичной упаковки, вариант упаковки 2



Фото 17. Образец внешнего вида вторичной упаковки



Фото 18. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 19. Общий вид первичной упаковки



Фото 20. Образец внешнего вида вторичной упаковки

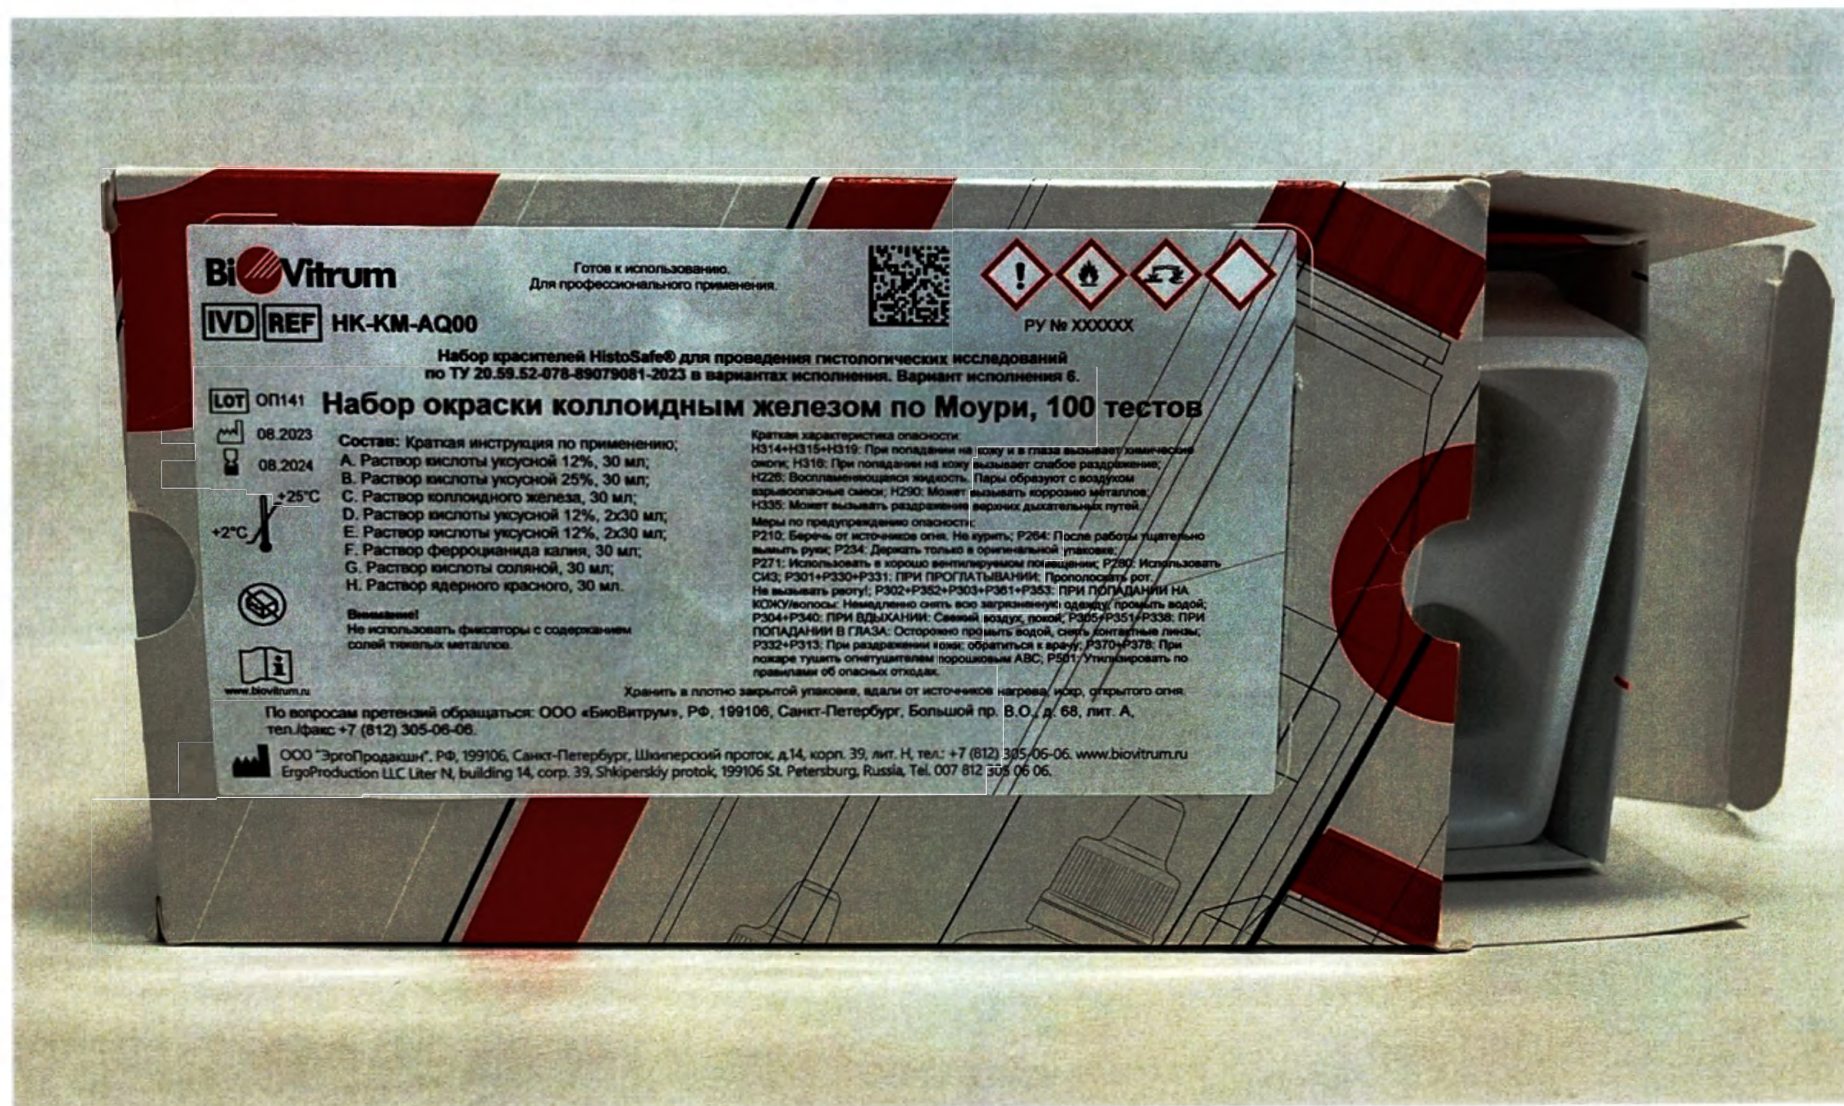


Фото 21. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 22. Общий вид первичной упаковки



Фото 23. Образец внешнего вида вторичной упаковки

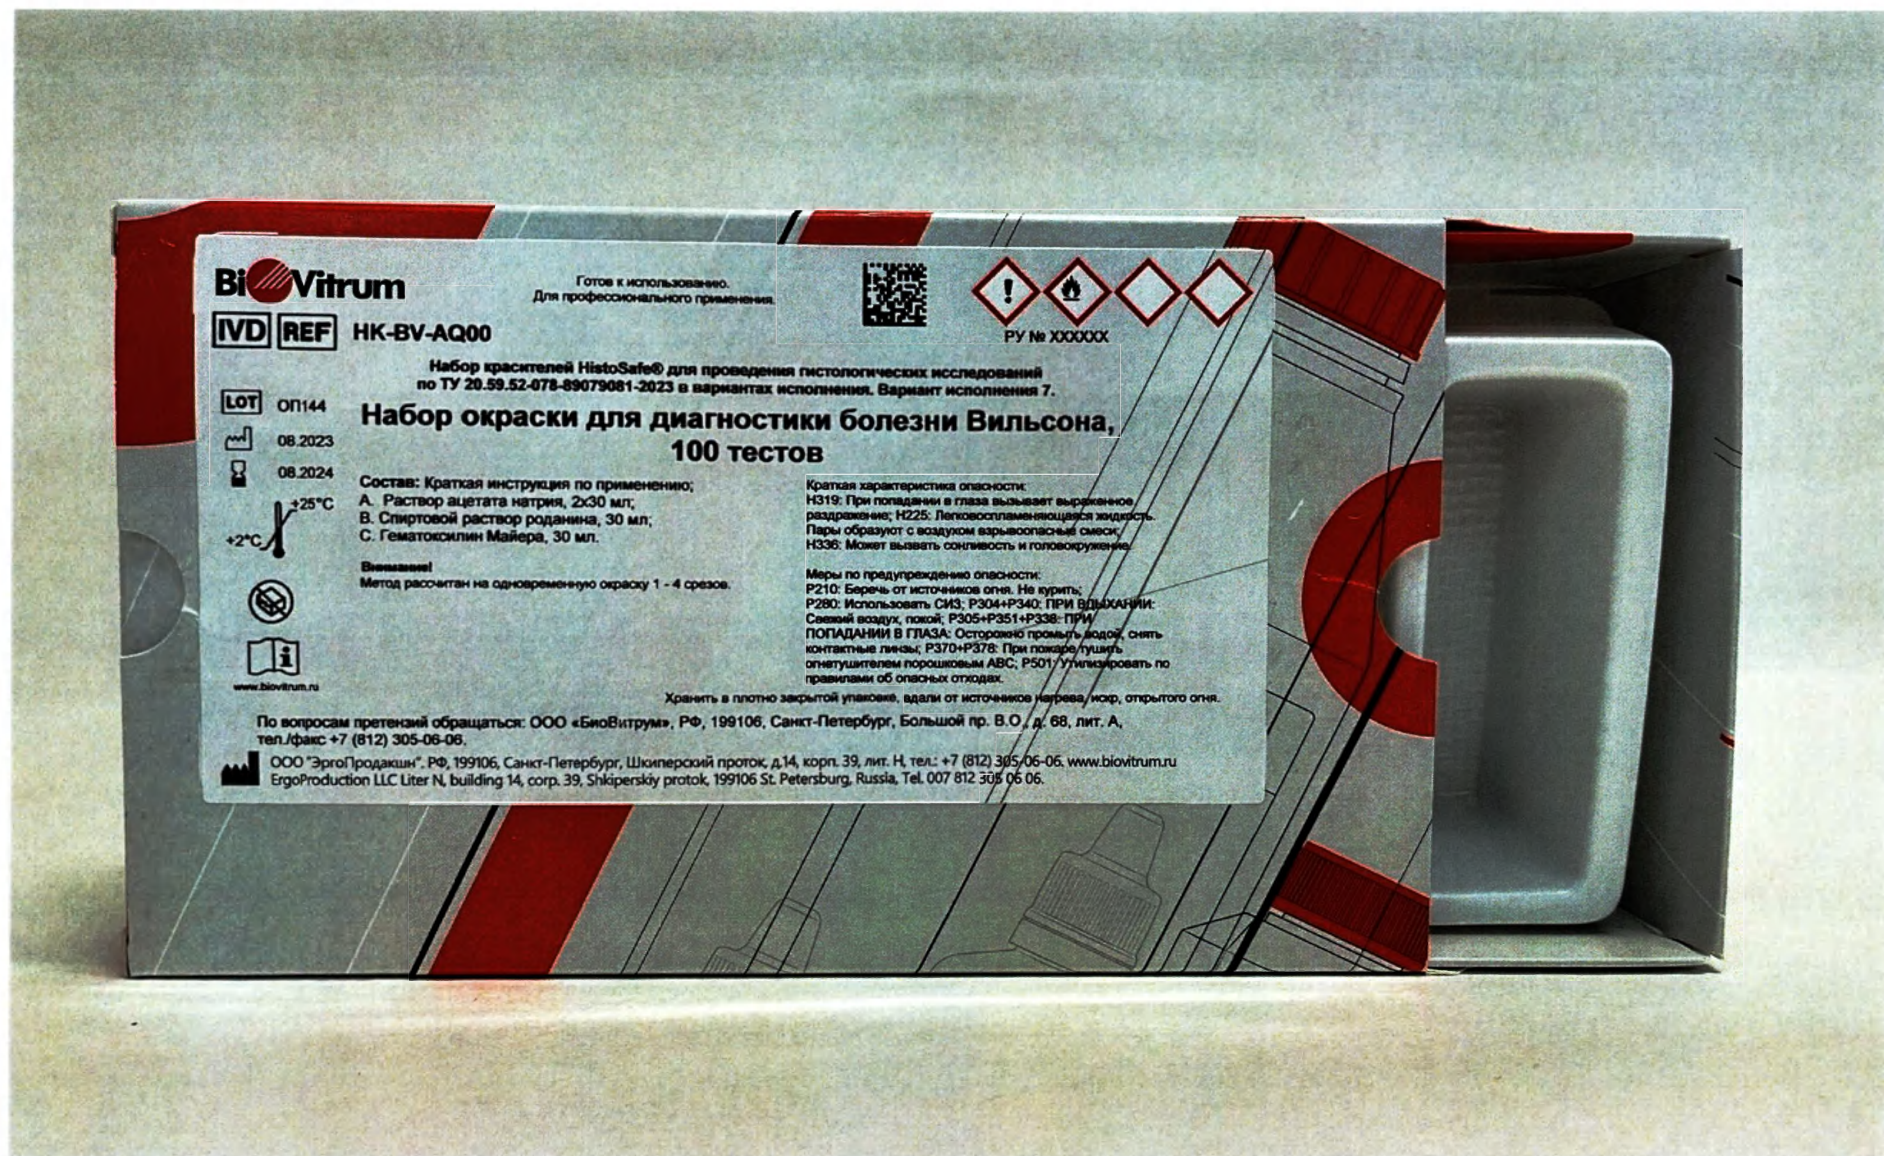



Фото 24. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 25. Общий вид первичной упаковки



Фото 26. Образец внешнего вида вторичной упаковки

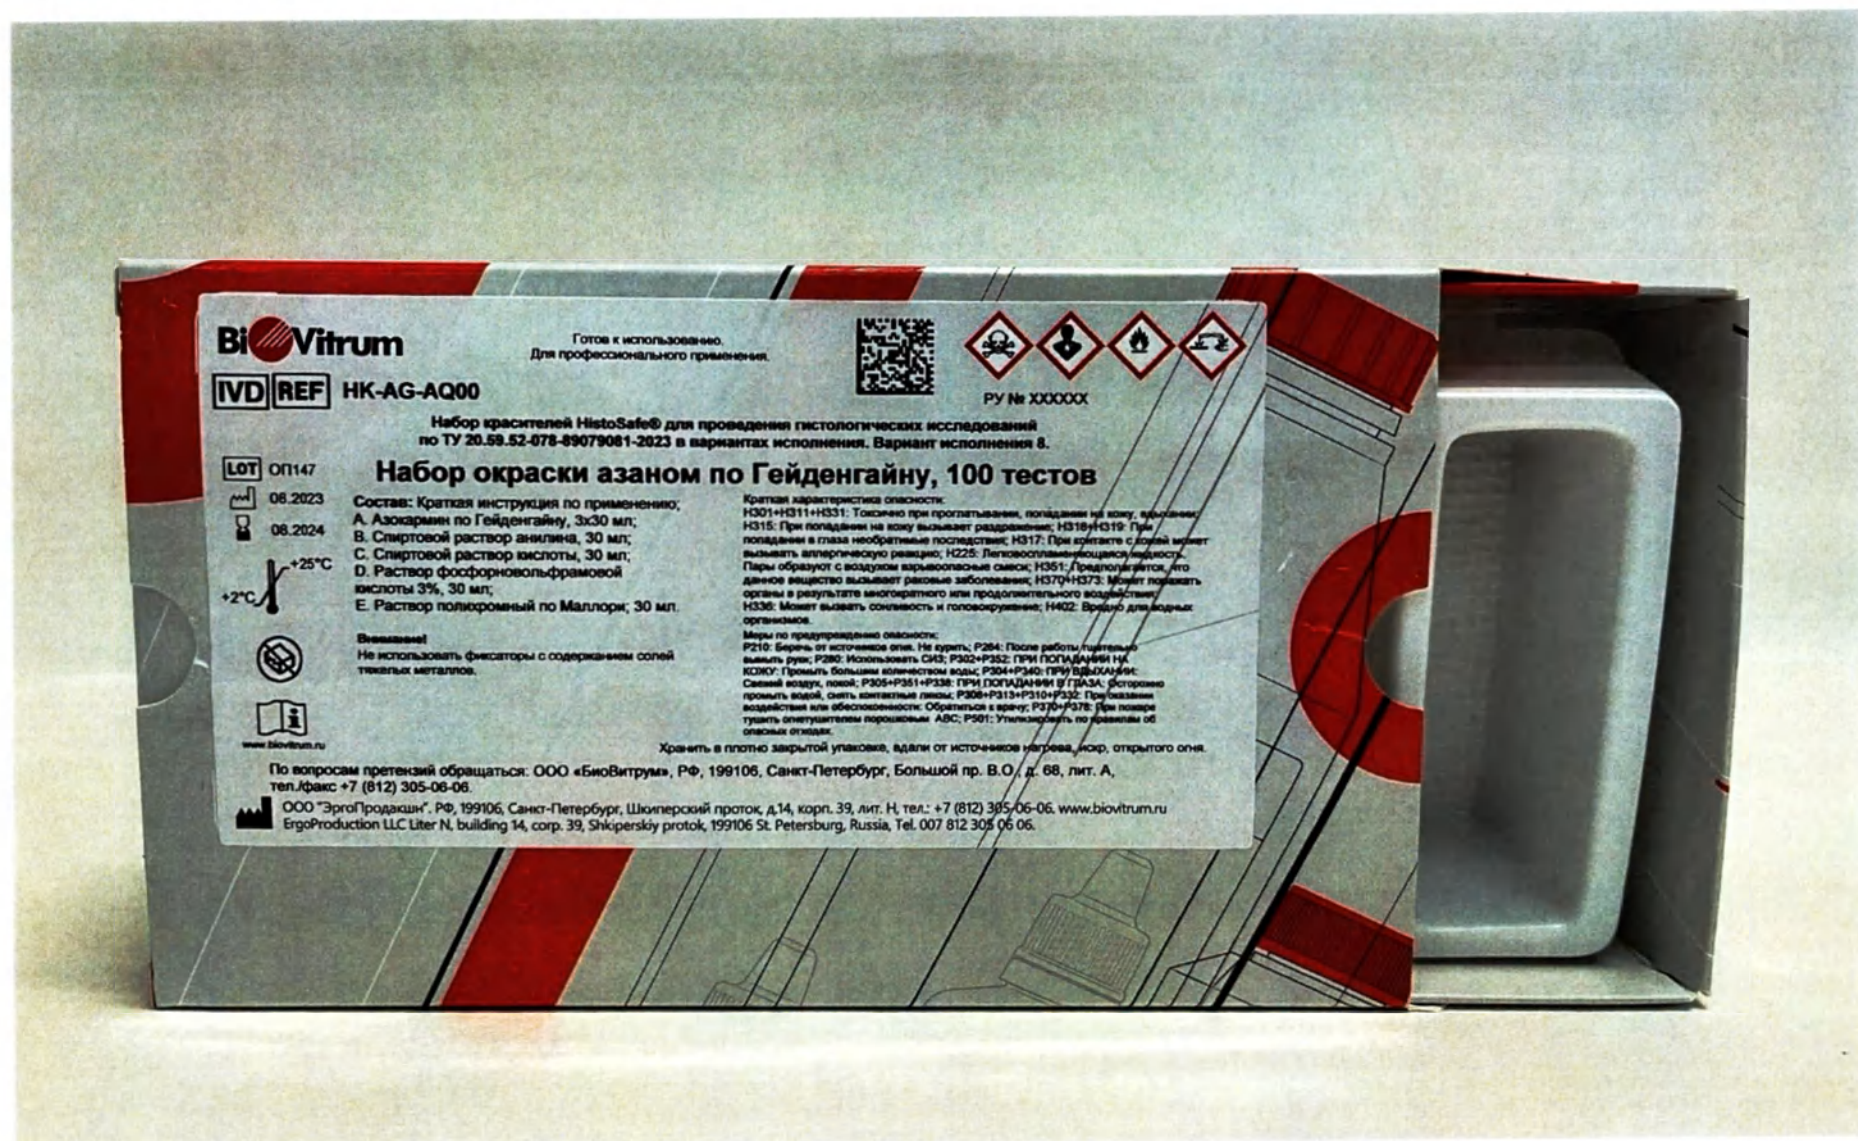

2.9 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 9. Набор окраски по Коссу, 100 тестов


Фото 27. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 28. Общий вид первичной упаковки



Фото 29. Образец внешнего вида вторичной упаковки

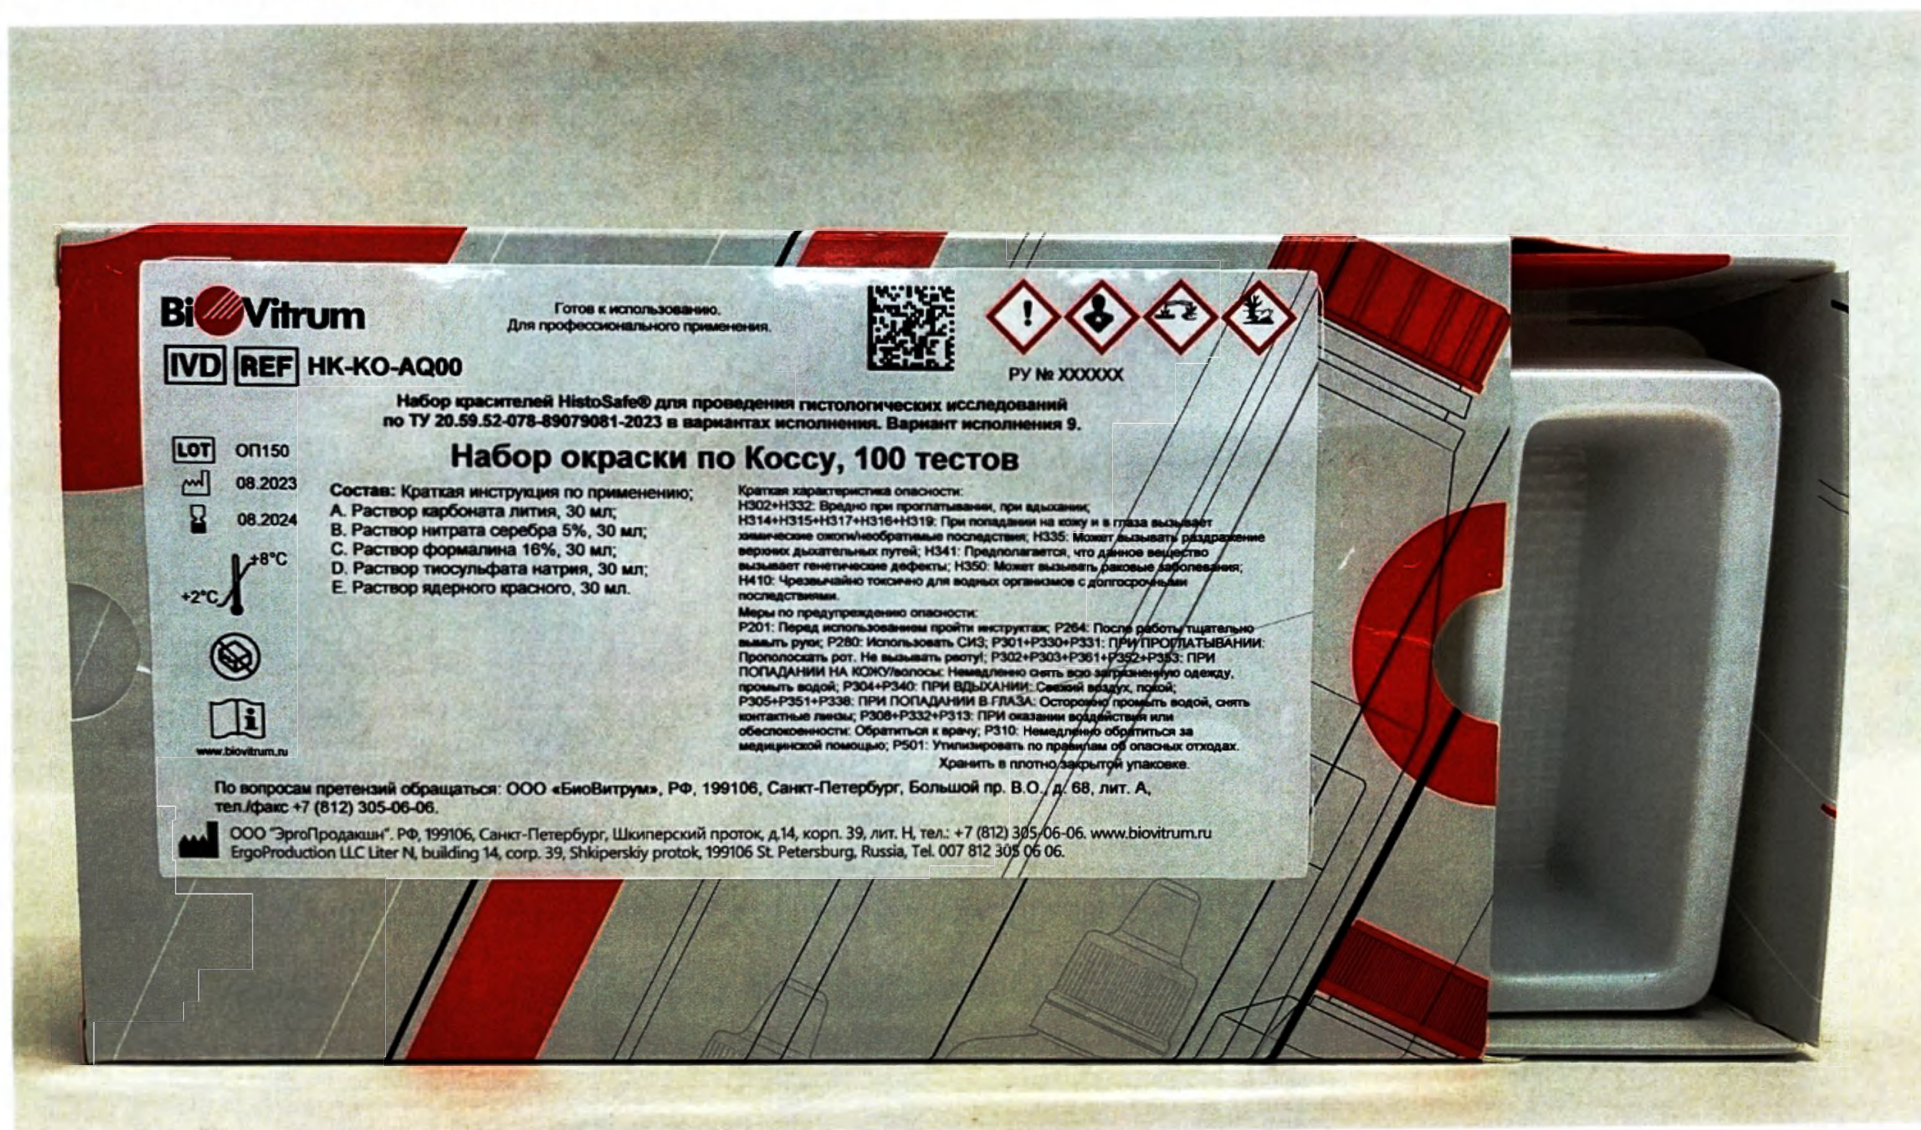

2.10 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 10. Набор окраски сириус красный, 100 тестов


Фото 30. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 31. Общий вид первичной упаковки



Фото 32. Образец внешнего вида вторичной упаковки

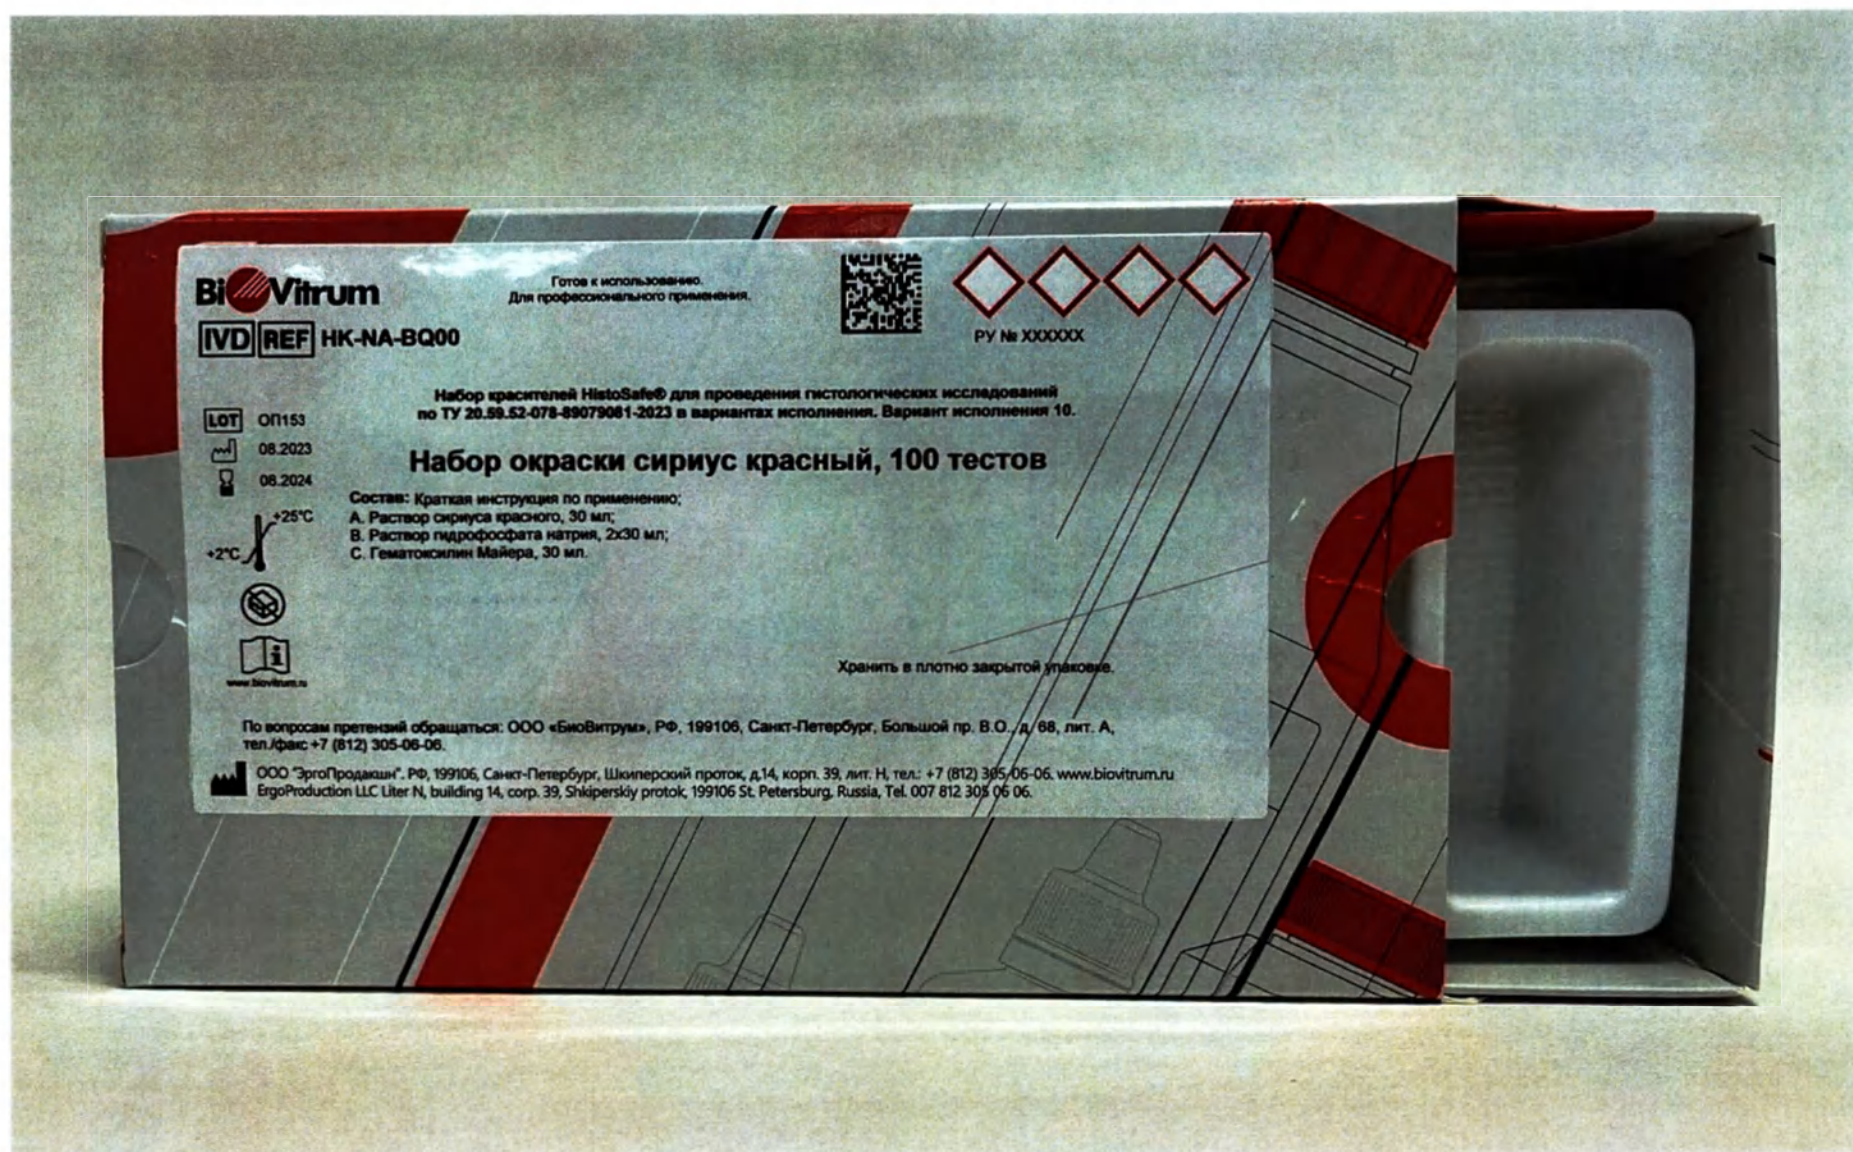

2.11 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 11. Набор окраски метенамин серебро PASM, 100 тестов

Фото 33. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 34. Общий вид первичной упаковки



Фото 35. Образец внешнего вида вторичной упаковки

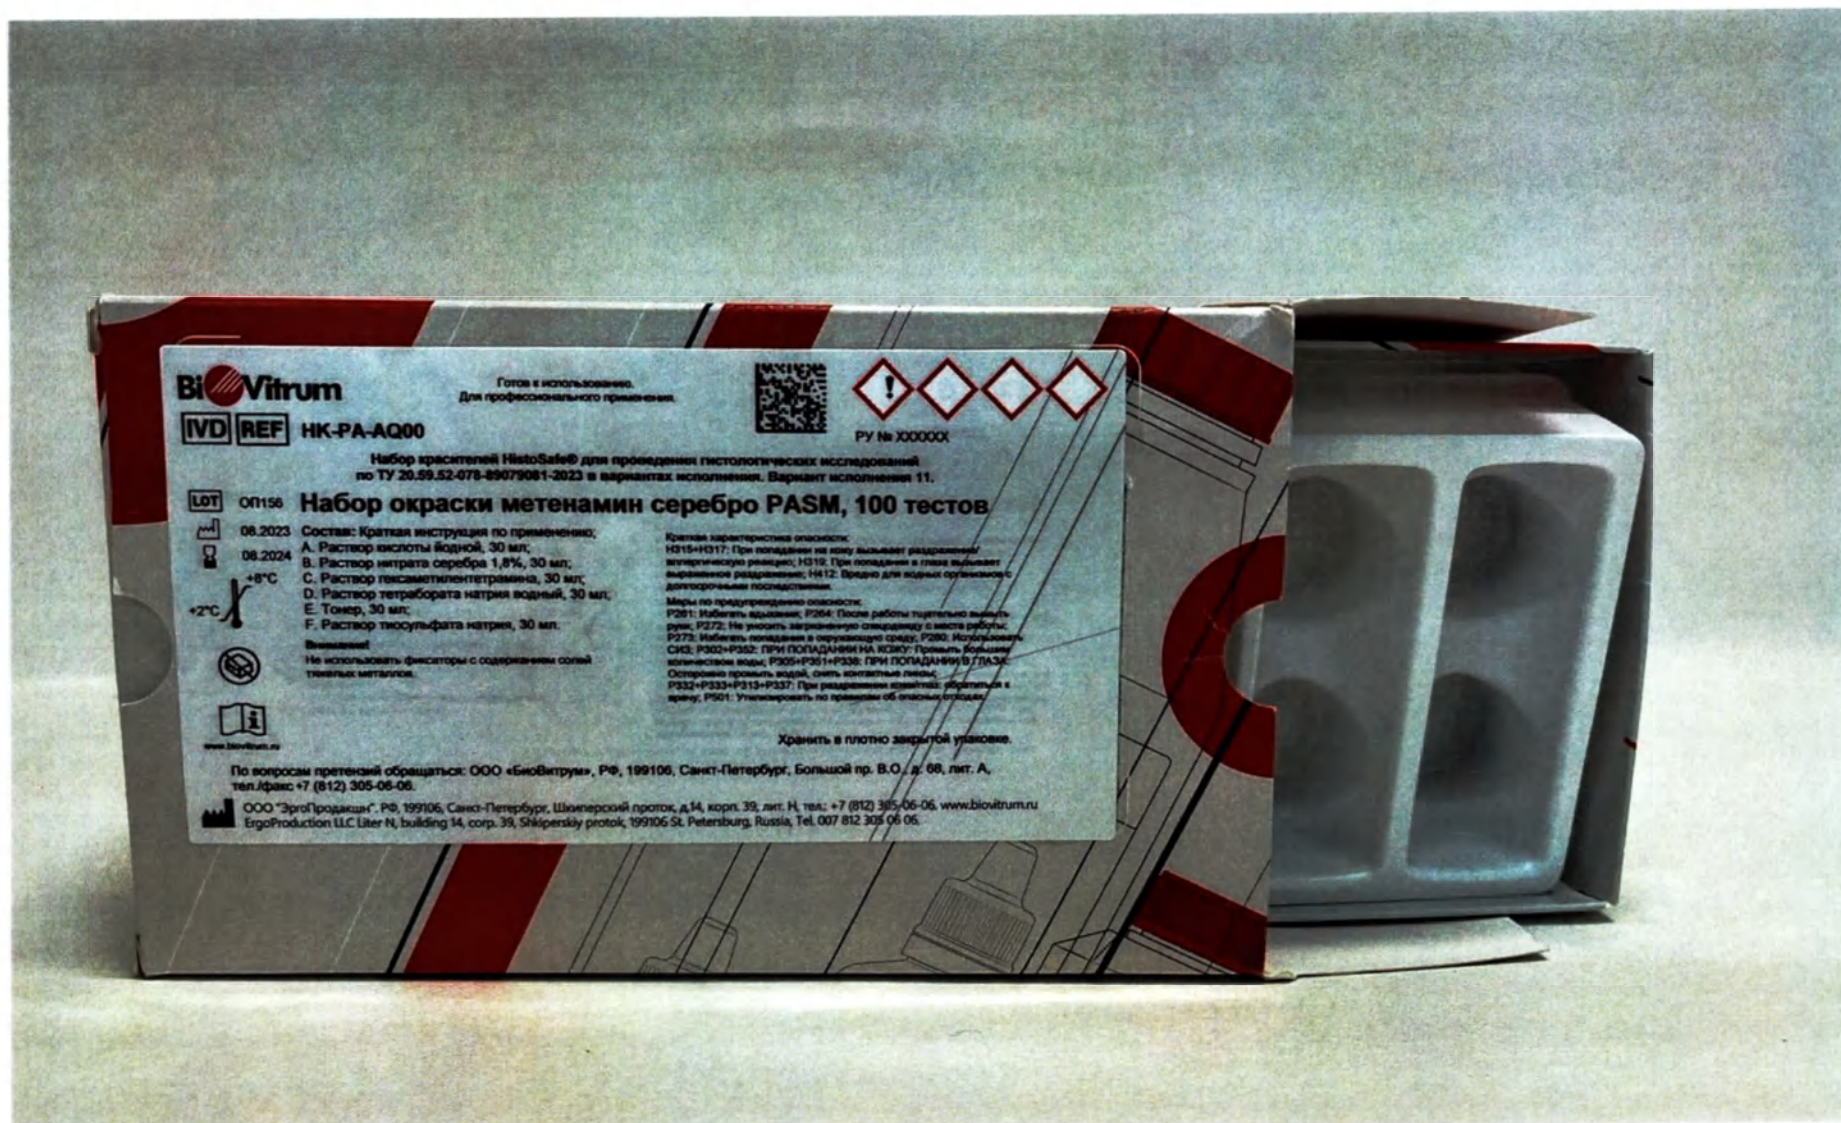


Фото 36. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 37. Общий вид первичной упаковки



Фото 38. Образец внешнего вида вторичной упаковки

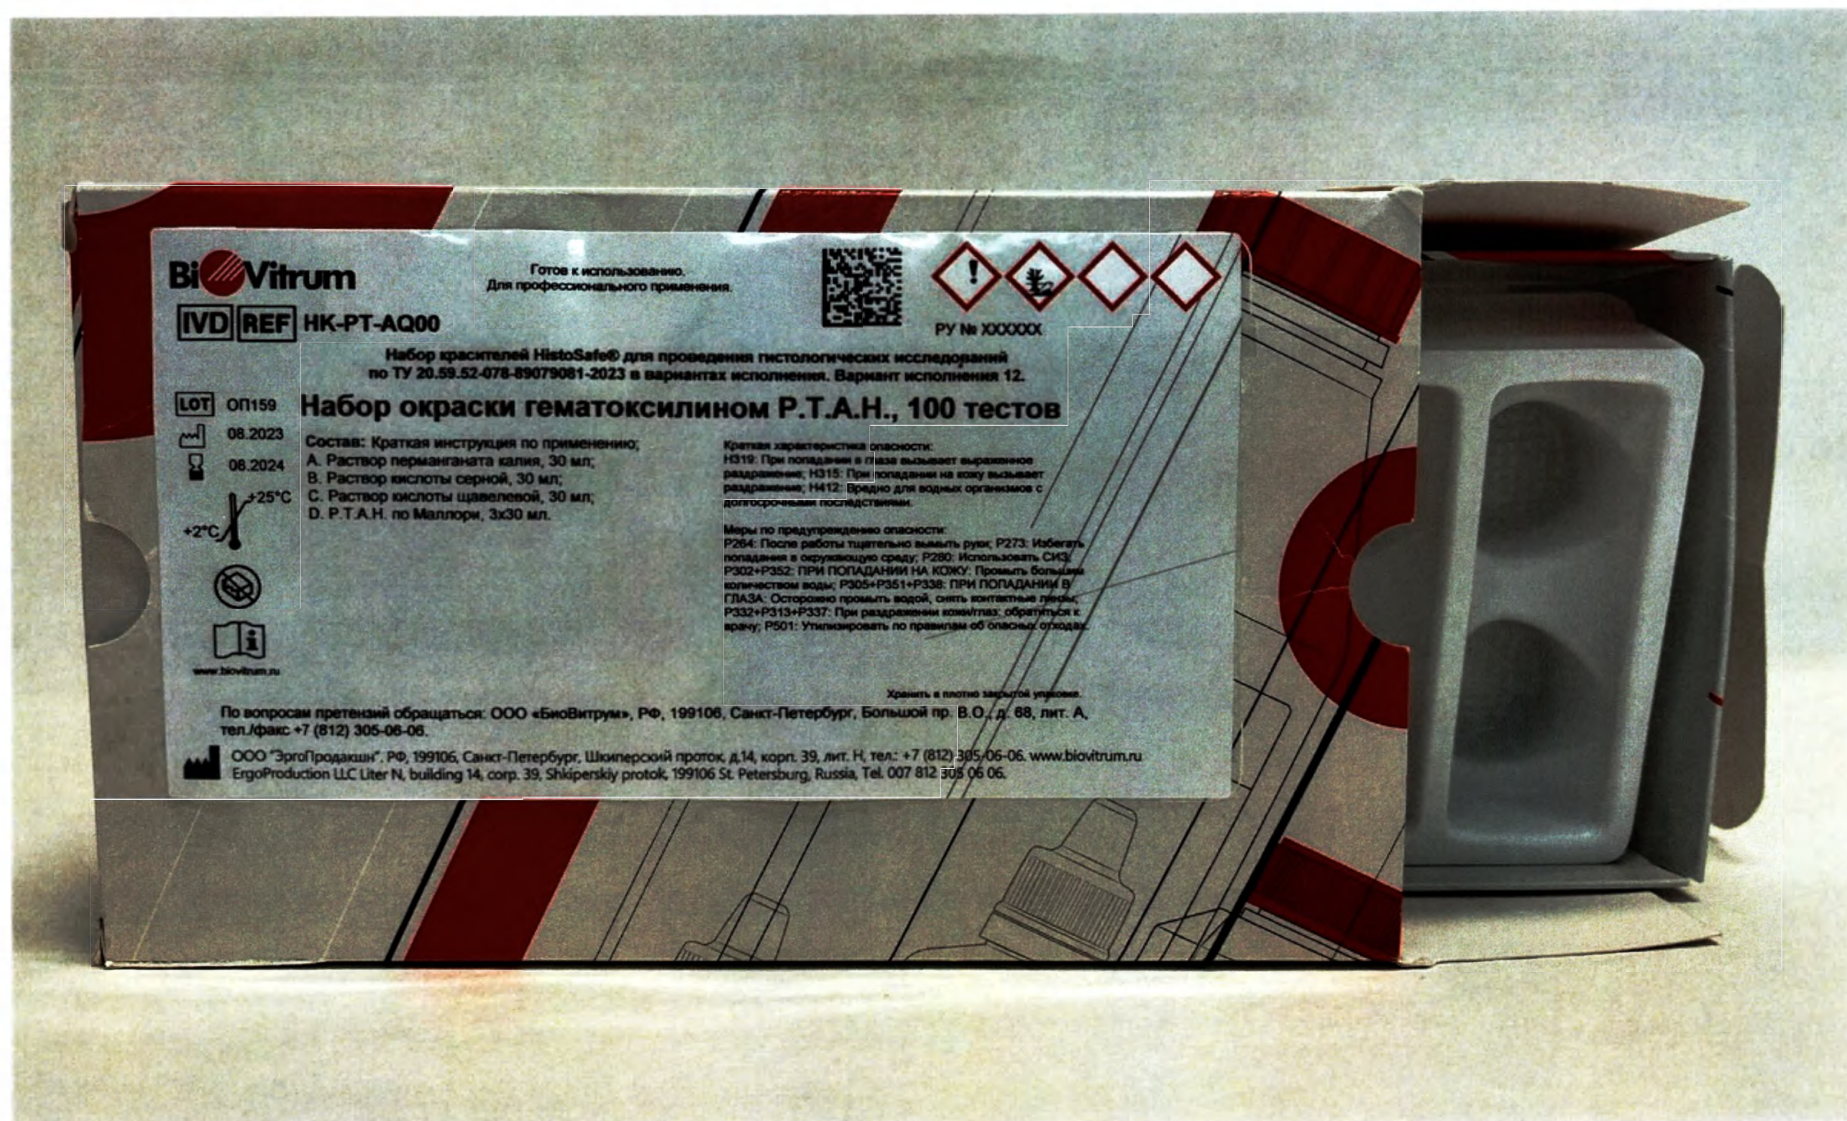


Фото 39. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 40. Общий вид первичной упаковки



Фото 41. Образец внешнего вида вторичной упаковки



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 79
(составляет девять) лист(ов)

Исполнительный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

"30" ноября 2023 г.

Д. В. Усейнов Д. В. Усейнов

