

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие:

«Иммобилизатор ортопедический FlexiOH[®], с принадлежностями, в вариантах исполнения»



Рисунок 1 Имobilизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 2 Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizeyCure®)



Рисунок 3. Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Вид снаружи)



Рисунок 4. Имobilизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Вид изнутри)

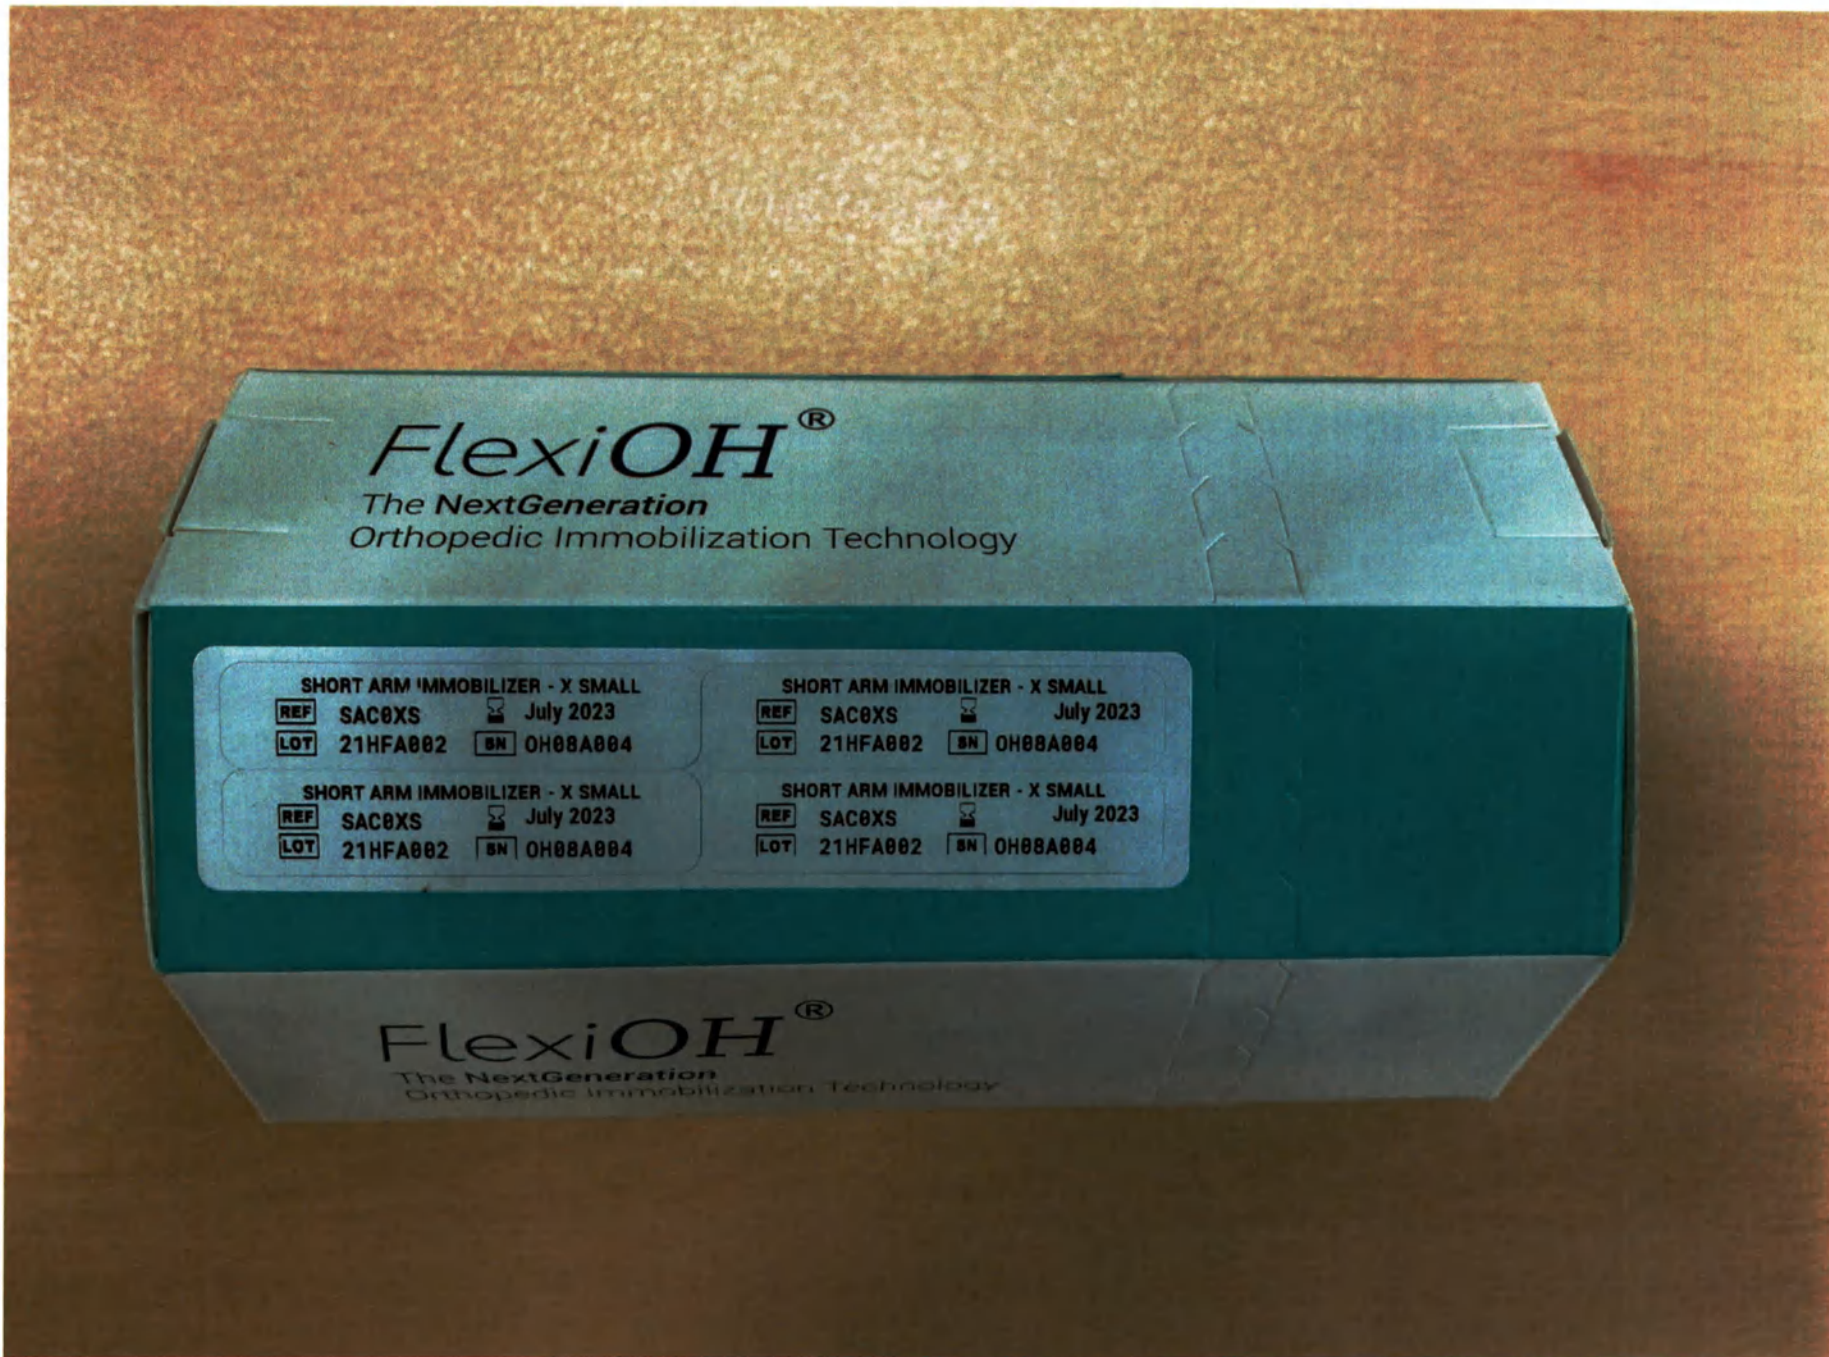


Рисунок 5. Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 6 Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Потребительская упаковка с маркировкой)

Рисунок 7. Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Индивидуальная упаковка)



Рисунок 8 Имобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® на примере размера XS (Маркировка индивидуальной упаковки)





Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий)
FlexiOH®**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 9 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH®



Рисунок 10 Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 11 Имobilизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizeCure®)

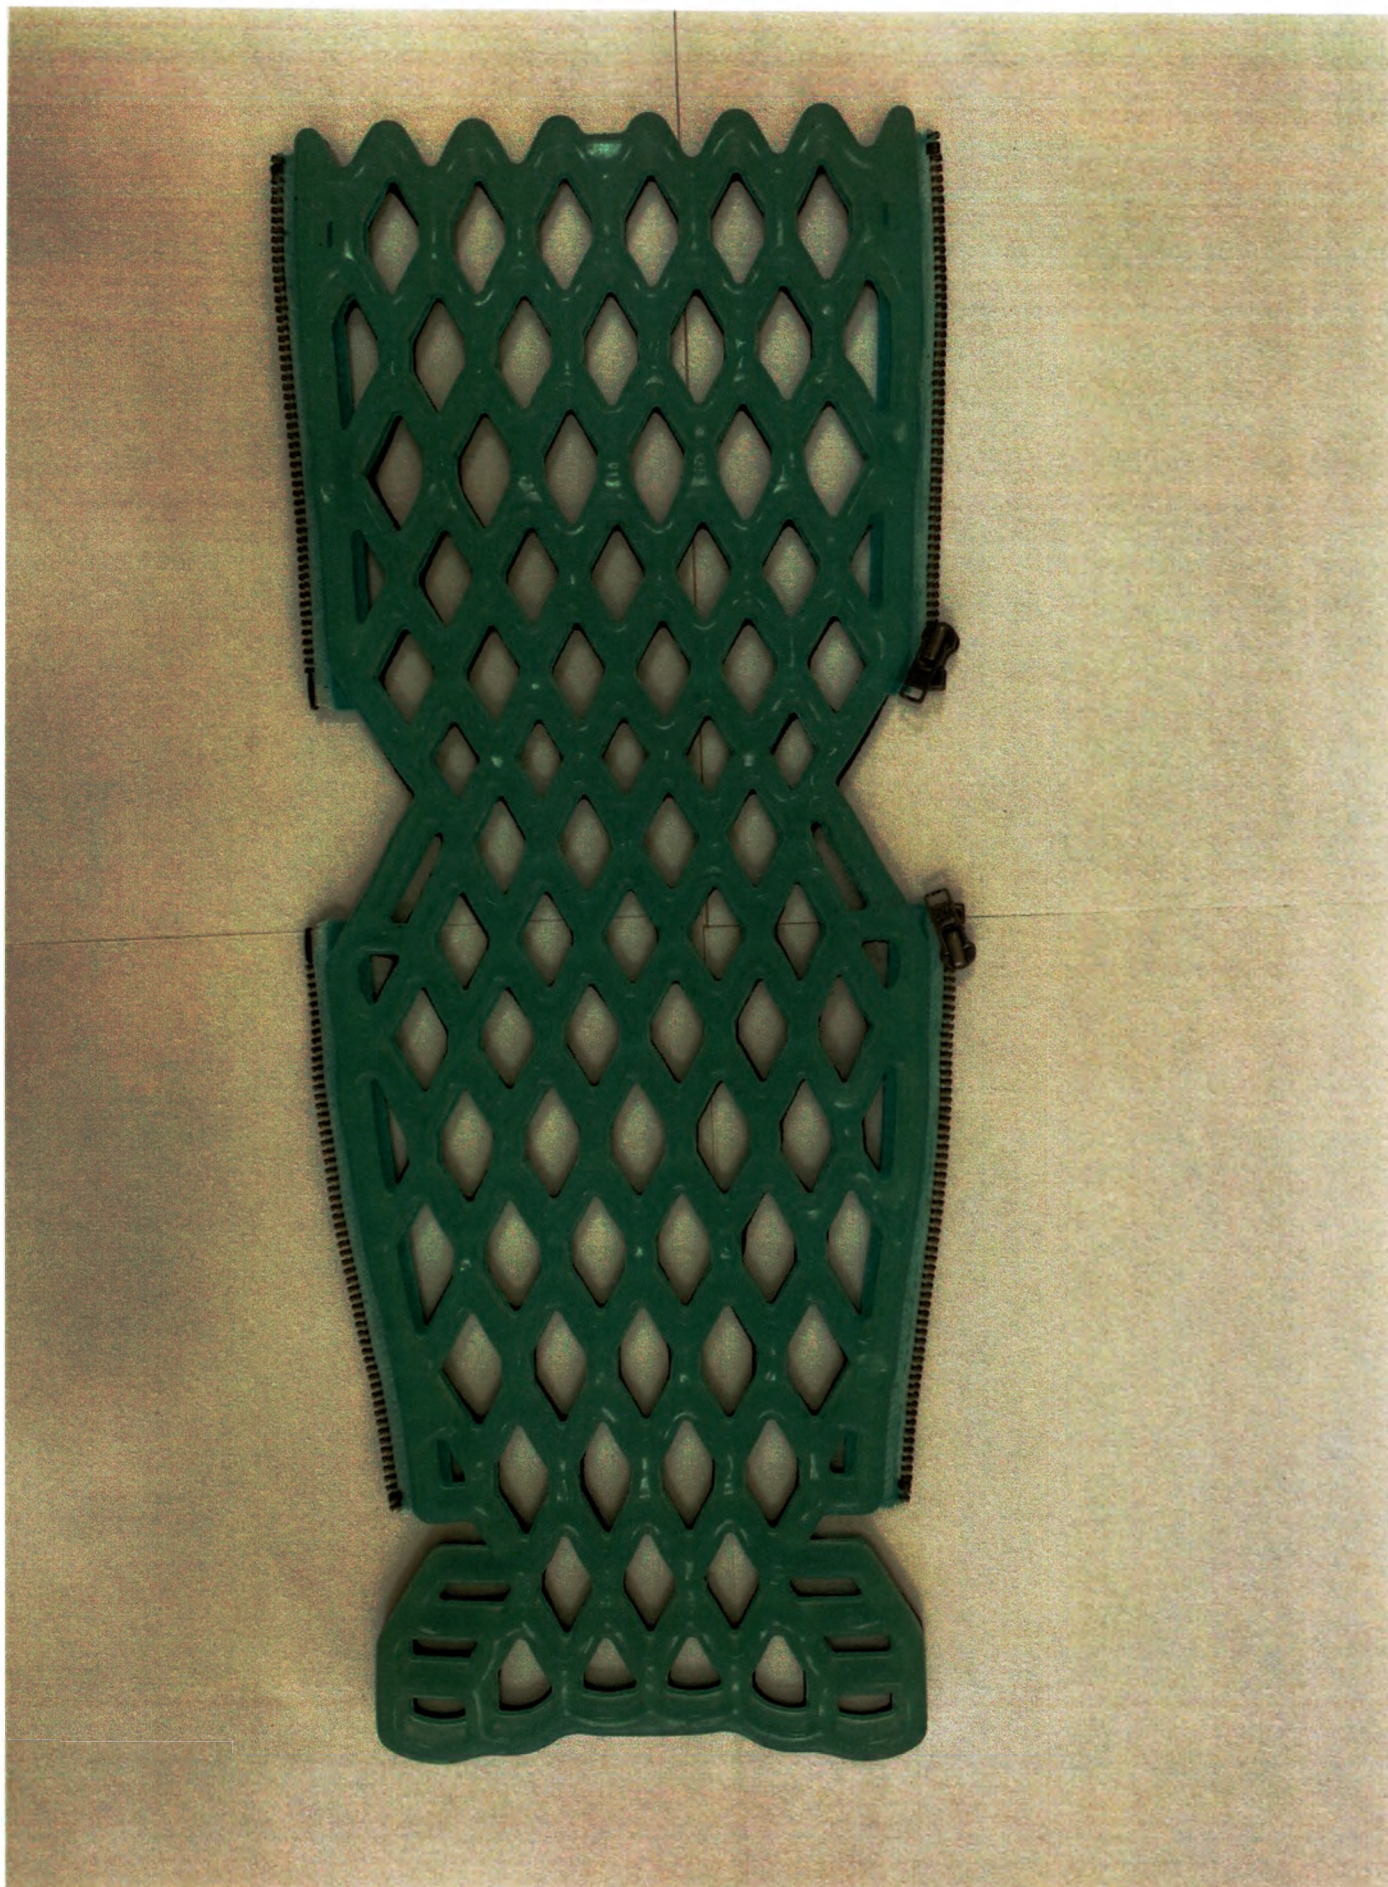


Рисунок 12. Имobilизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Вид снаружи)

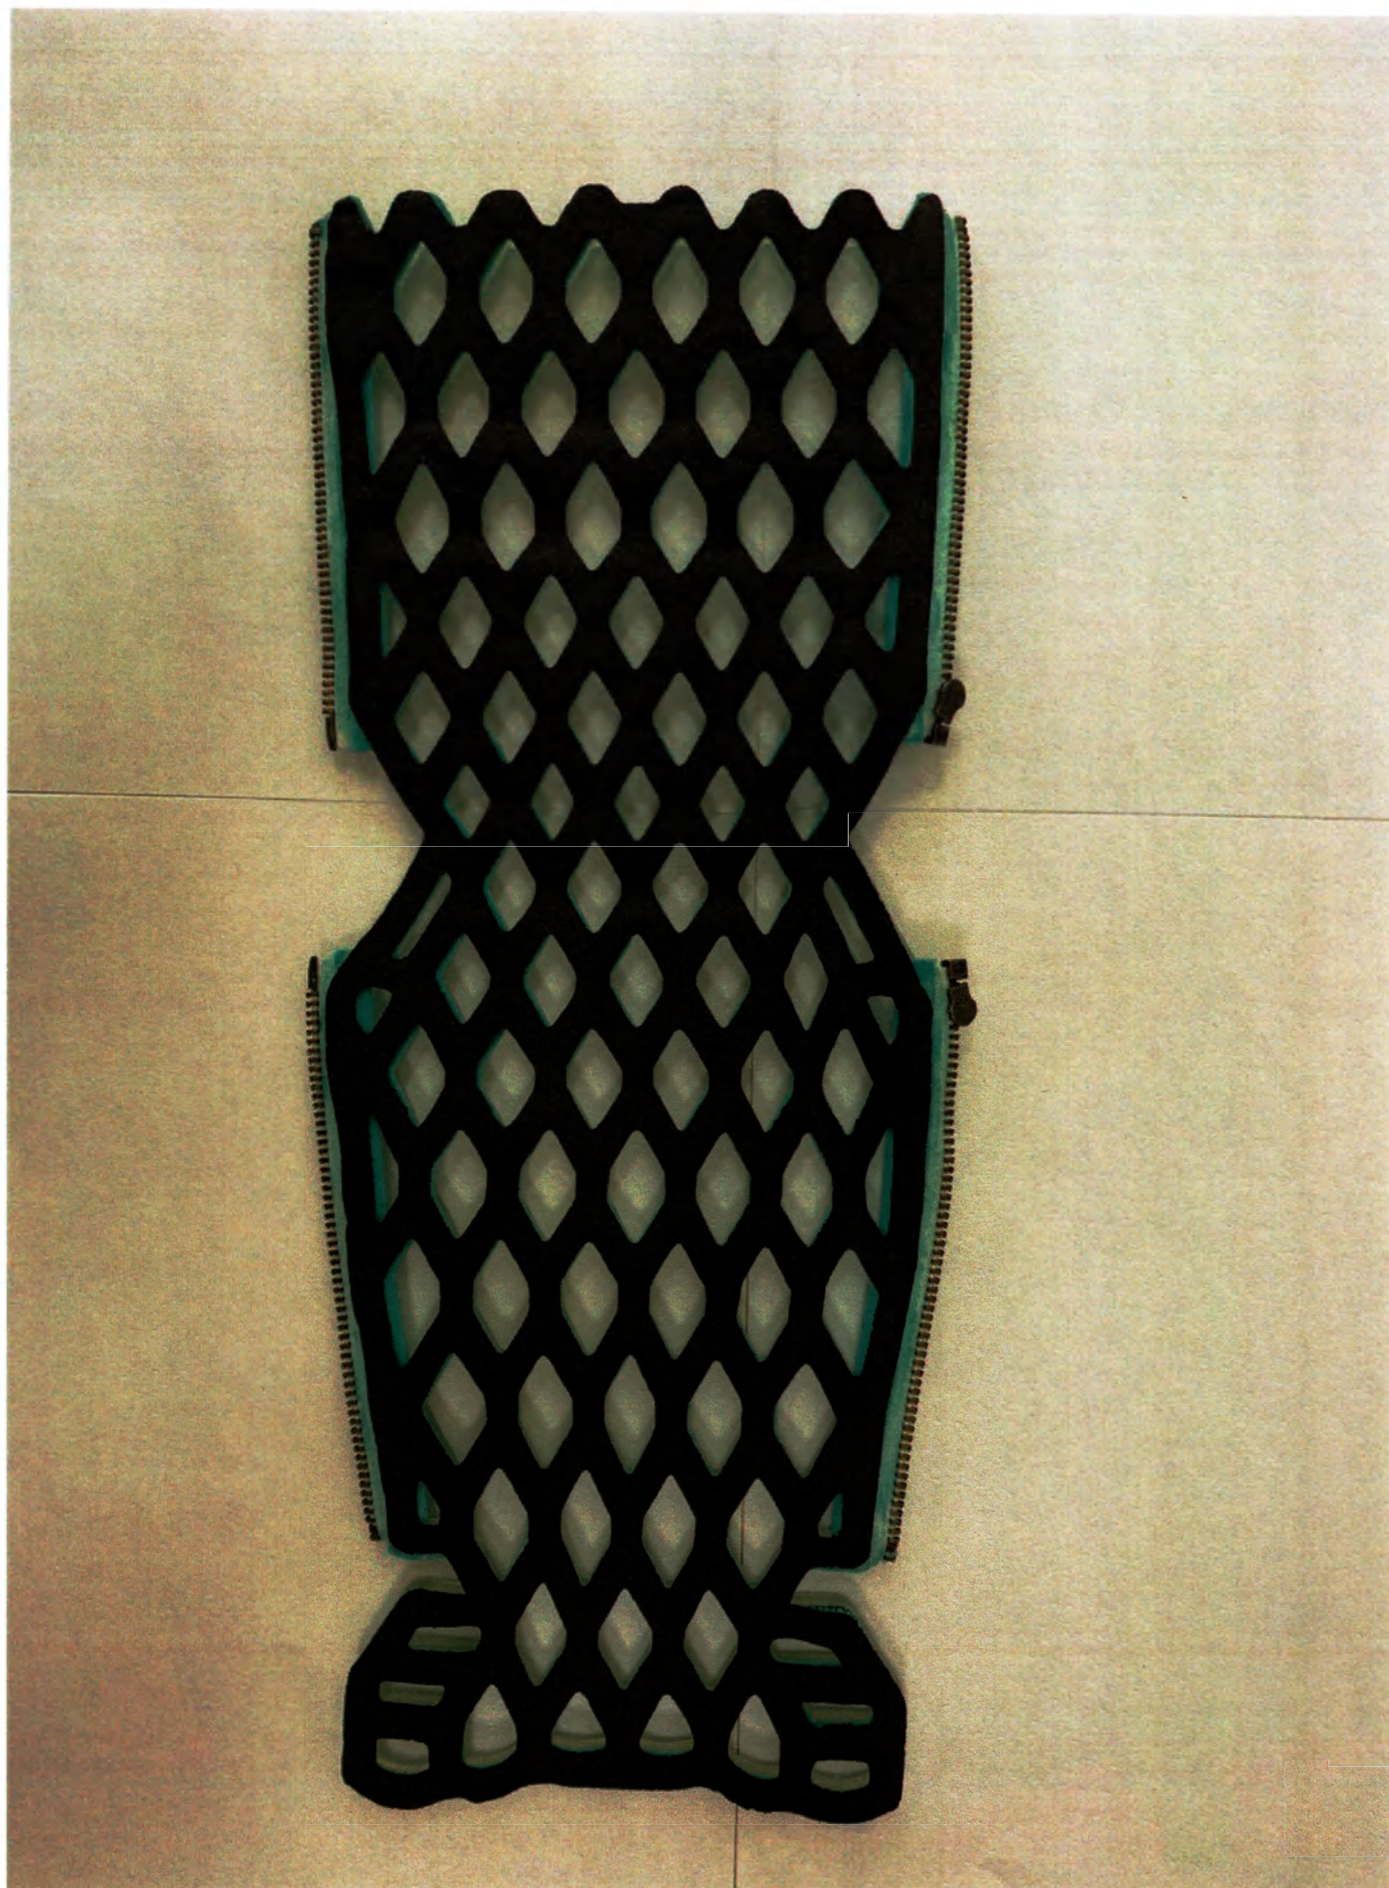


Рисунок 13. Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Вид изнутри)

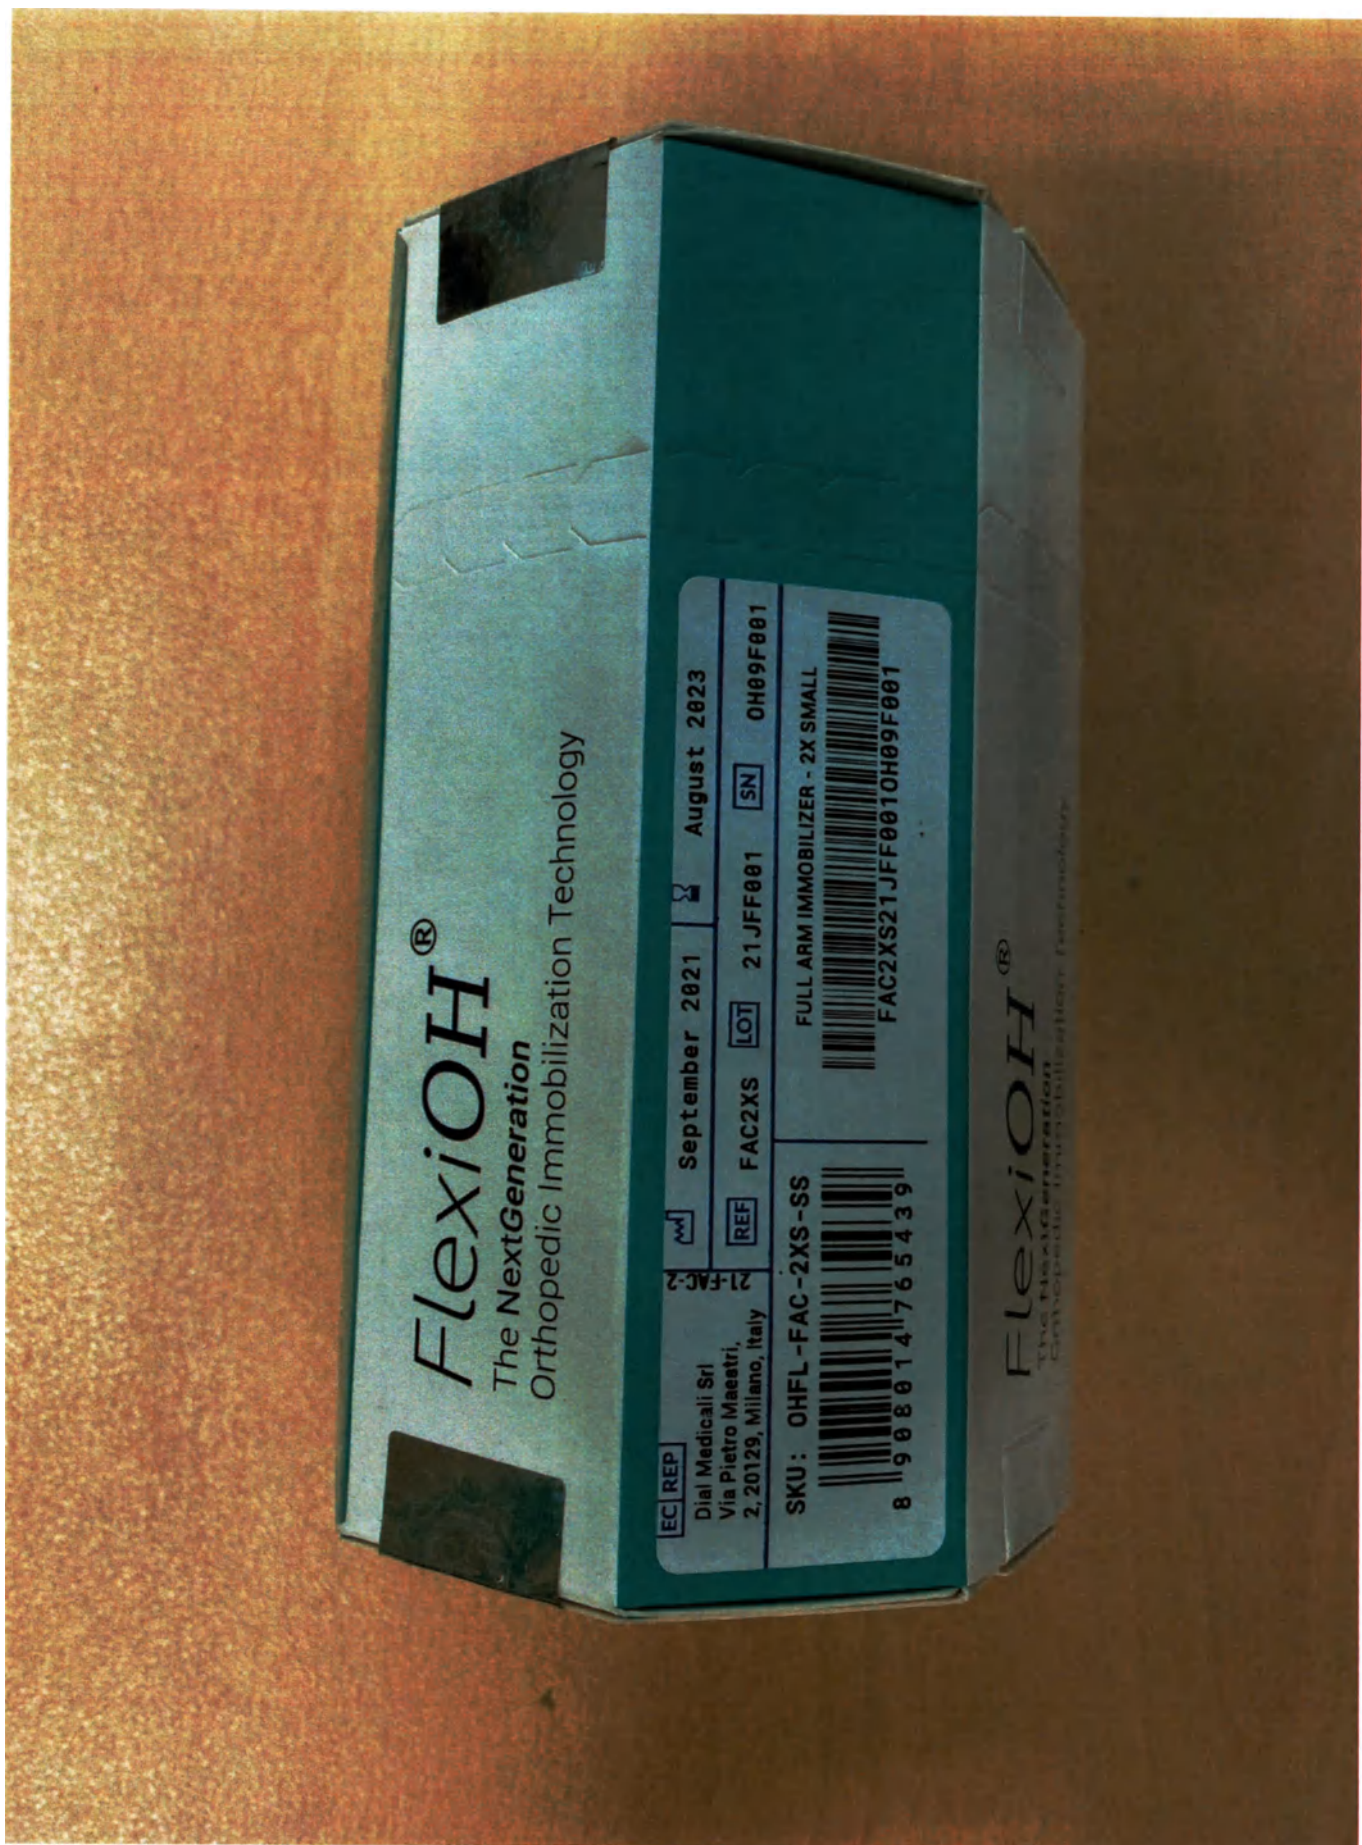


Рисунок 14. Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 15. Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH[®] на примере размера 2XS (потребительская упаковка с маркировкой)


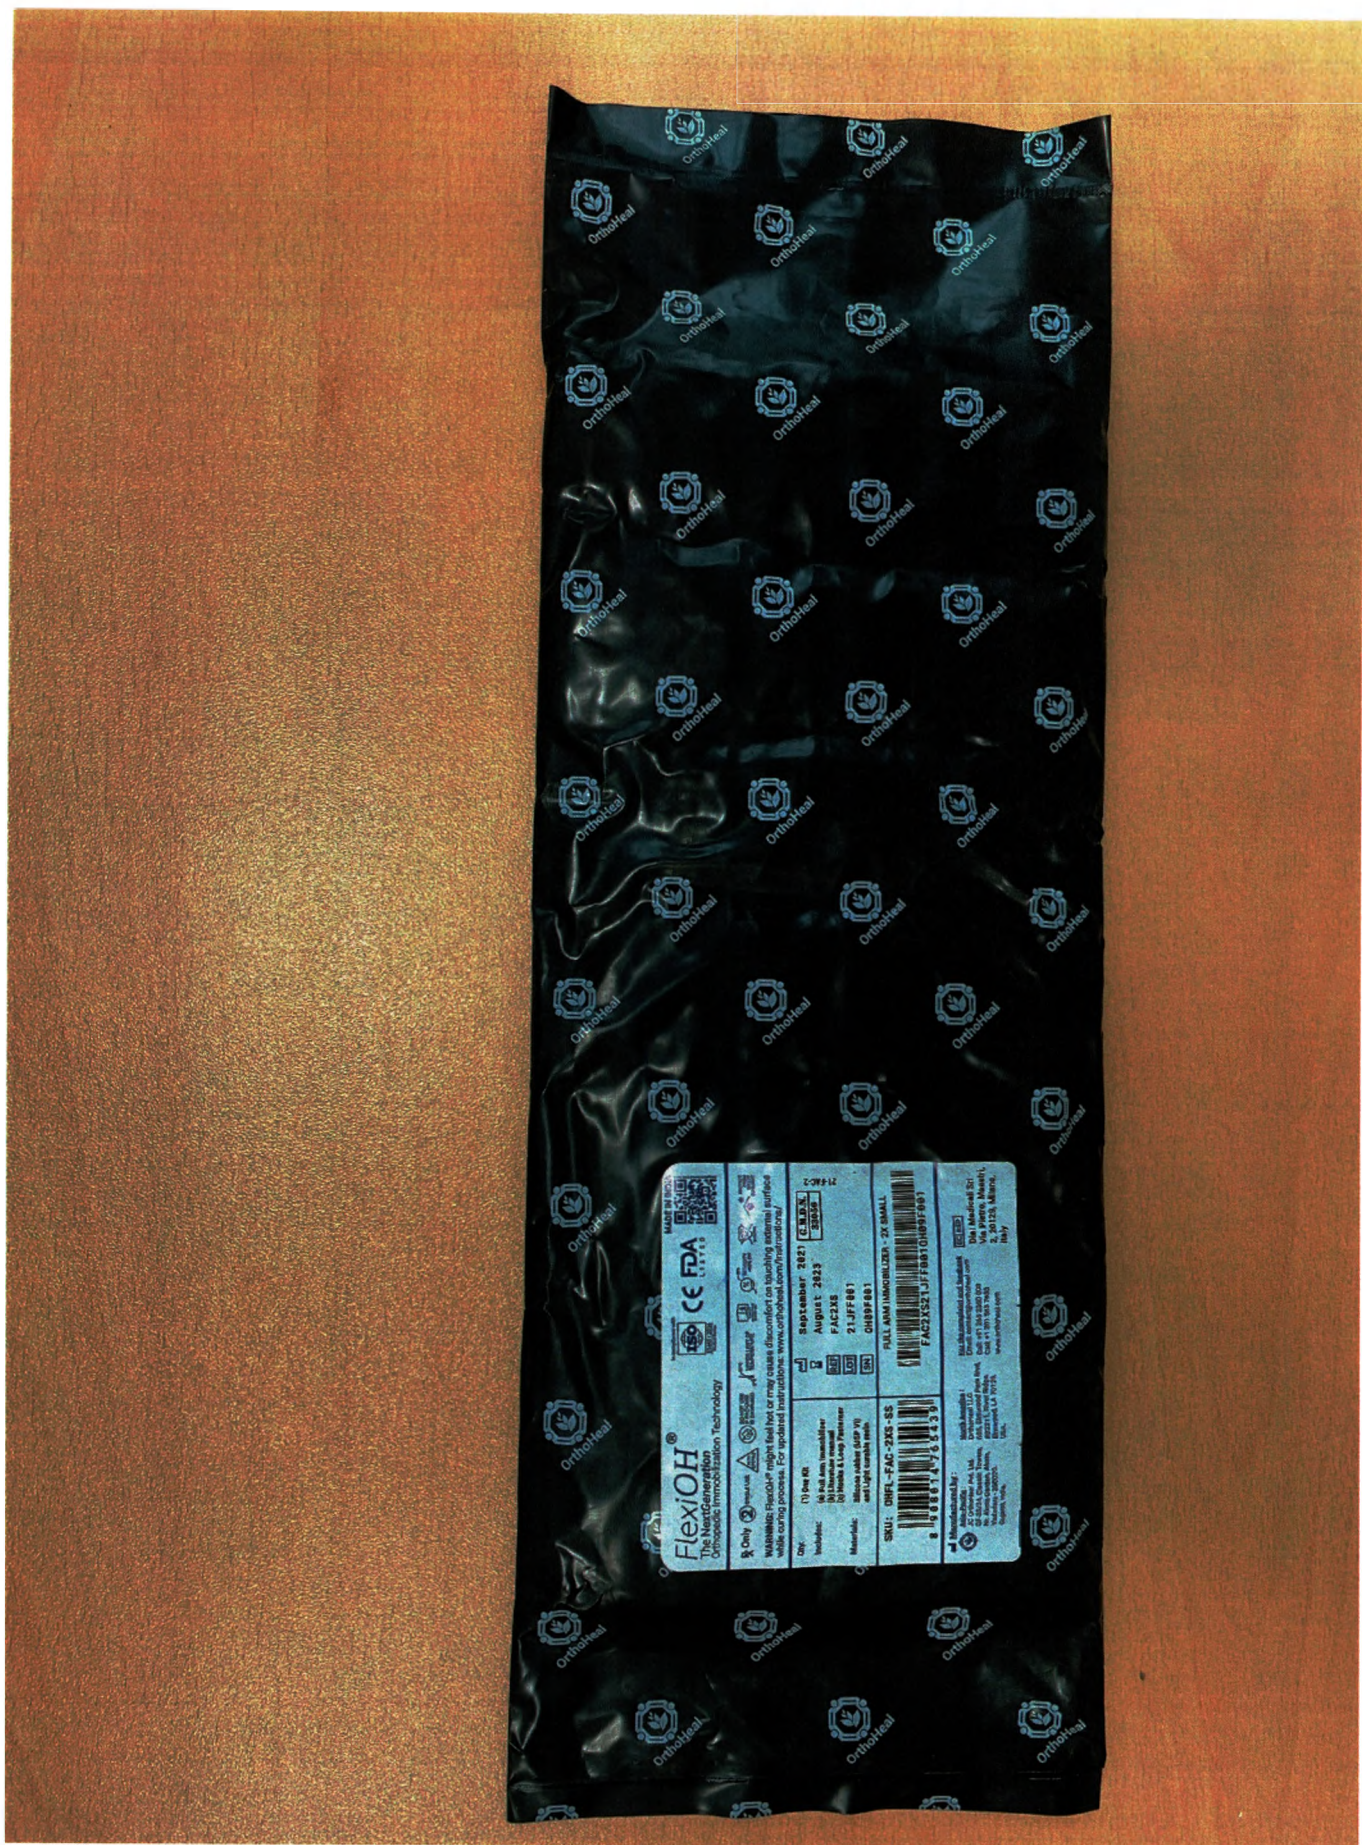


Рисунок 16. Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® на примере размера 2XS (Индивидуальная упаковка)



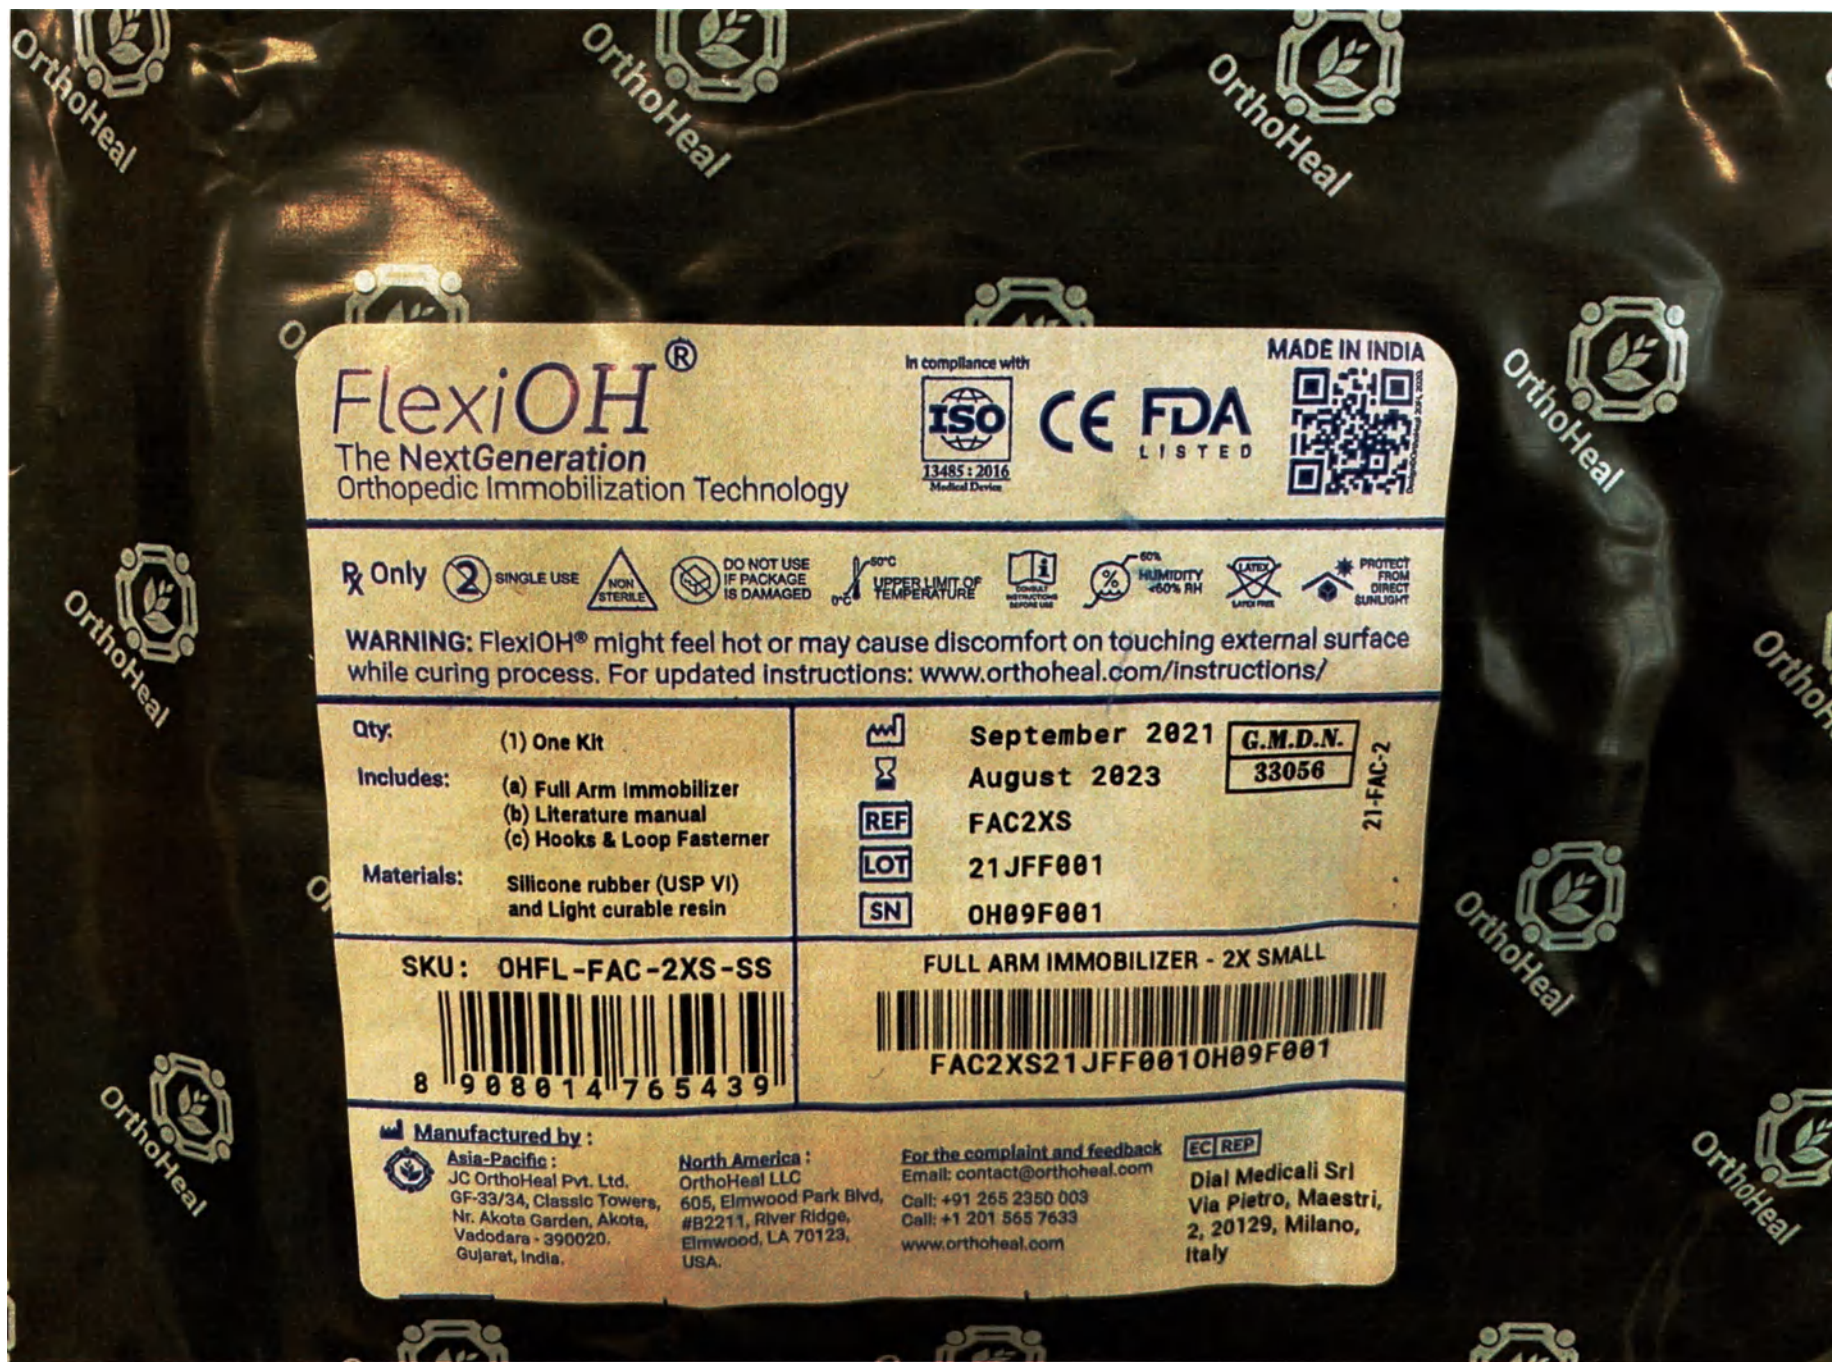

Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю
руку) FlexiON®**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 18 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiON®



Рисунок 19 Имobilизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure® и Накладка (чехол) на Имobilизатор ортопедический для ног FlexiShoe®)



Рисунок 20 Имobilизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure® и Накладка (чехол) на Имobilизатор ортопедический для ног FlexiShoe®)

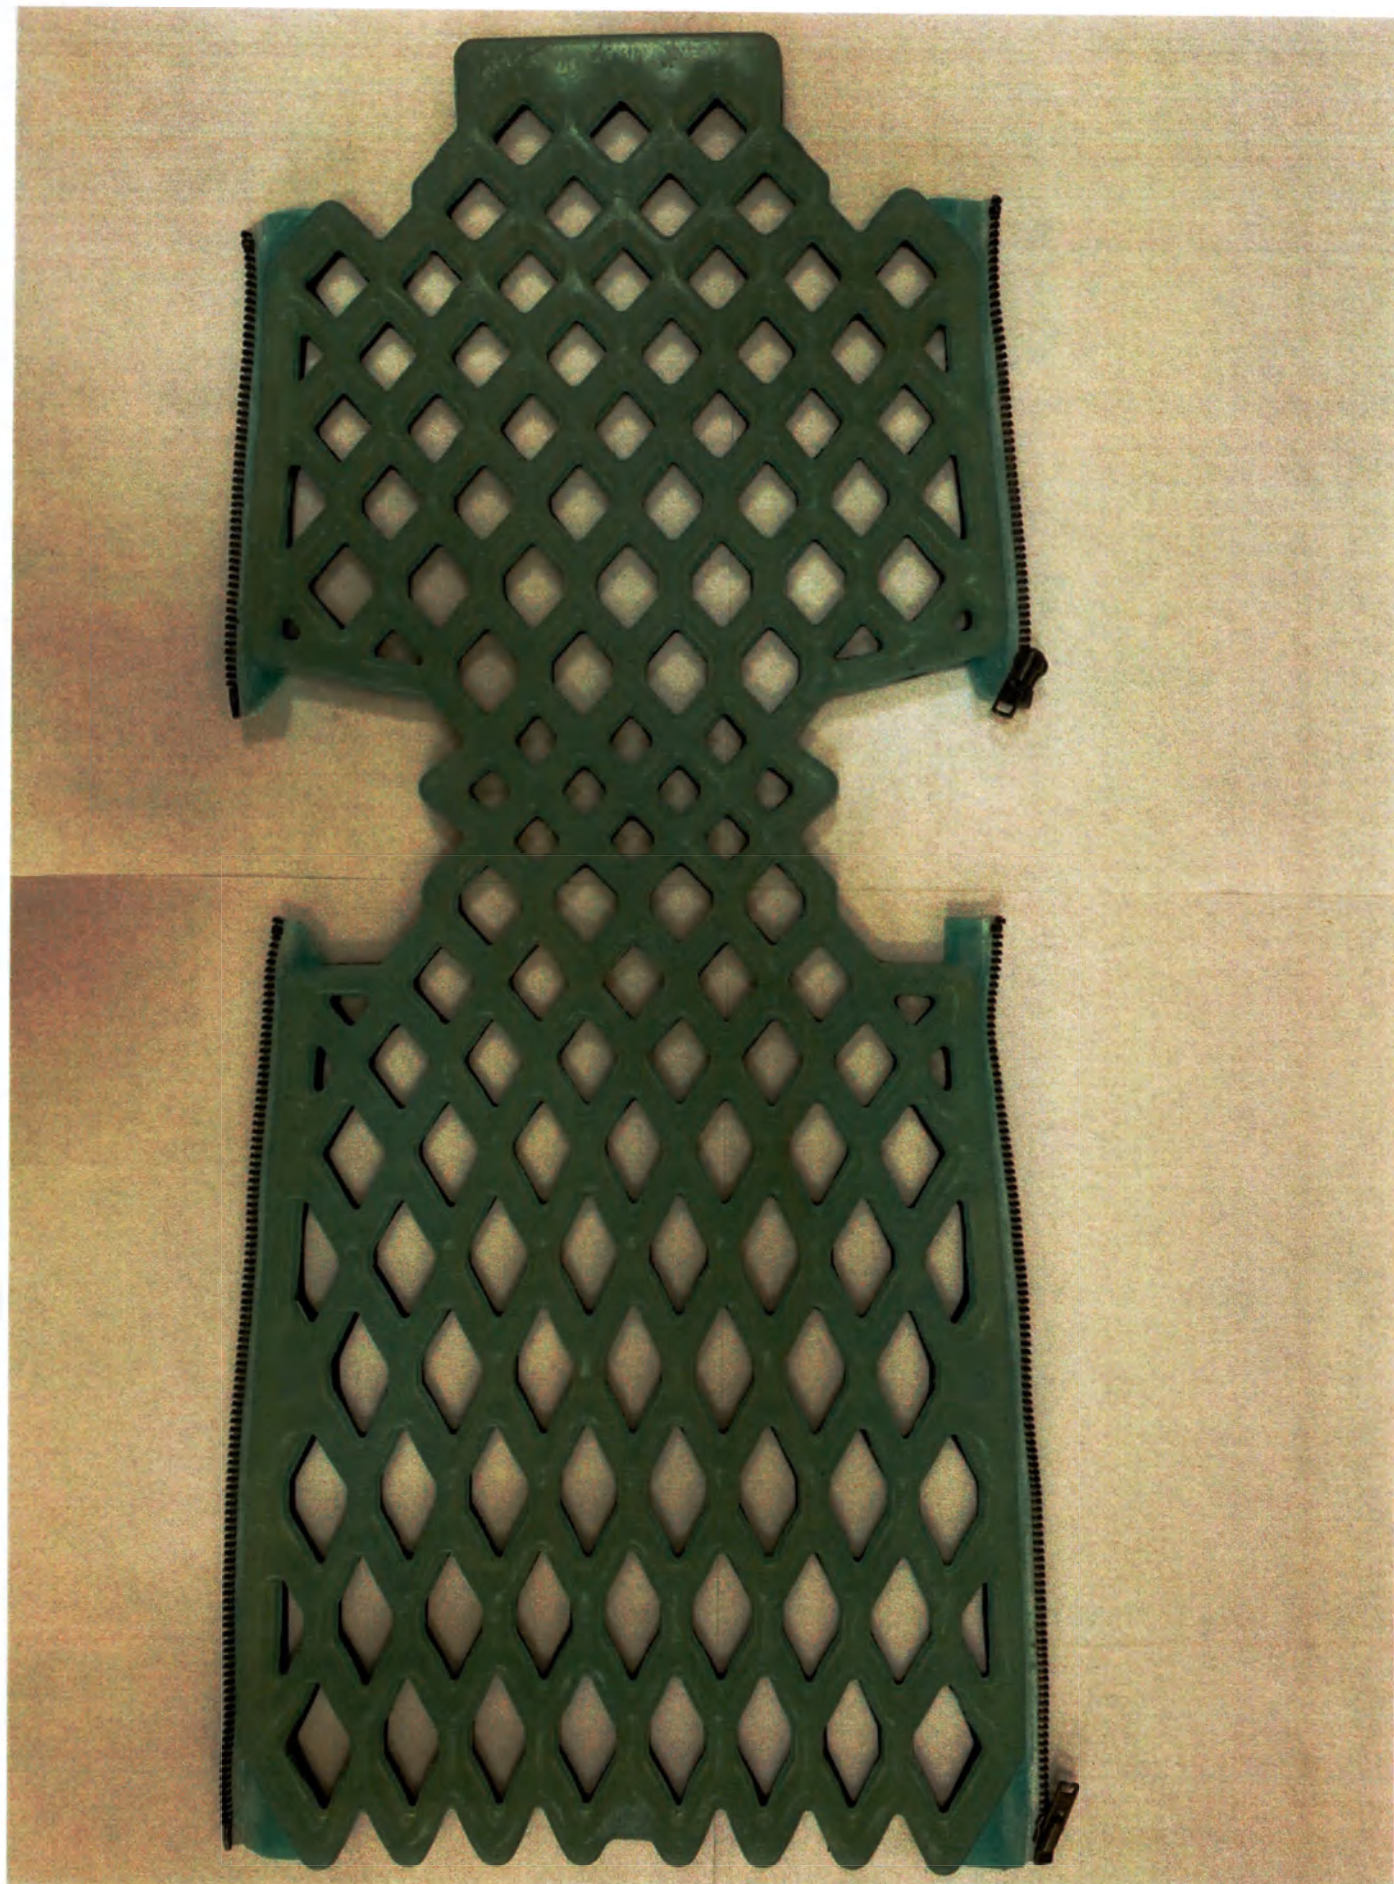


Рисунок 21. Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Вид снаружи)

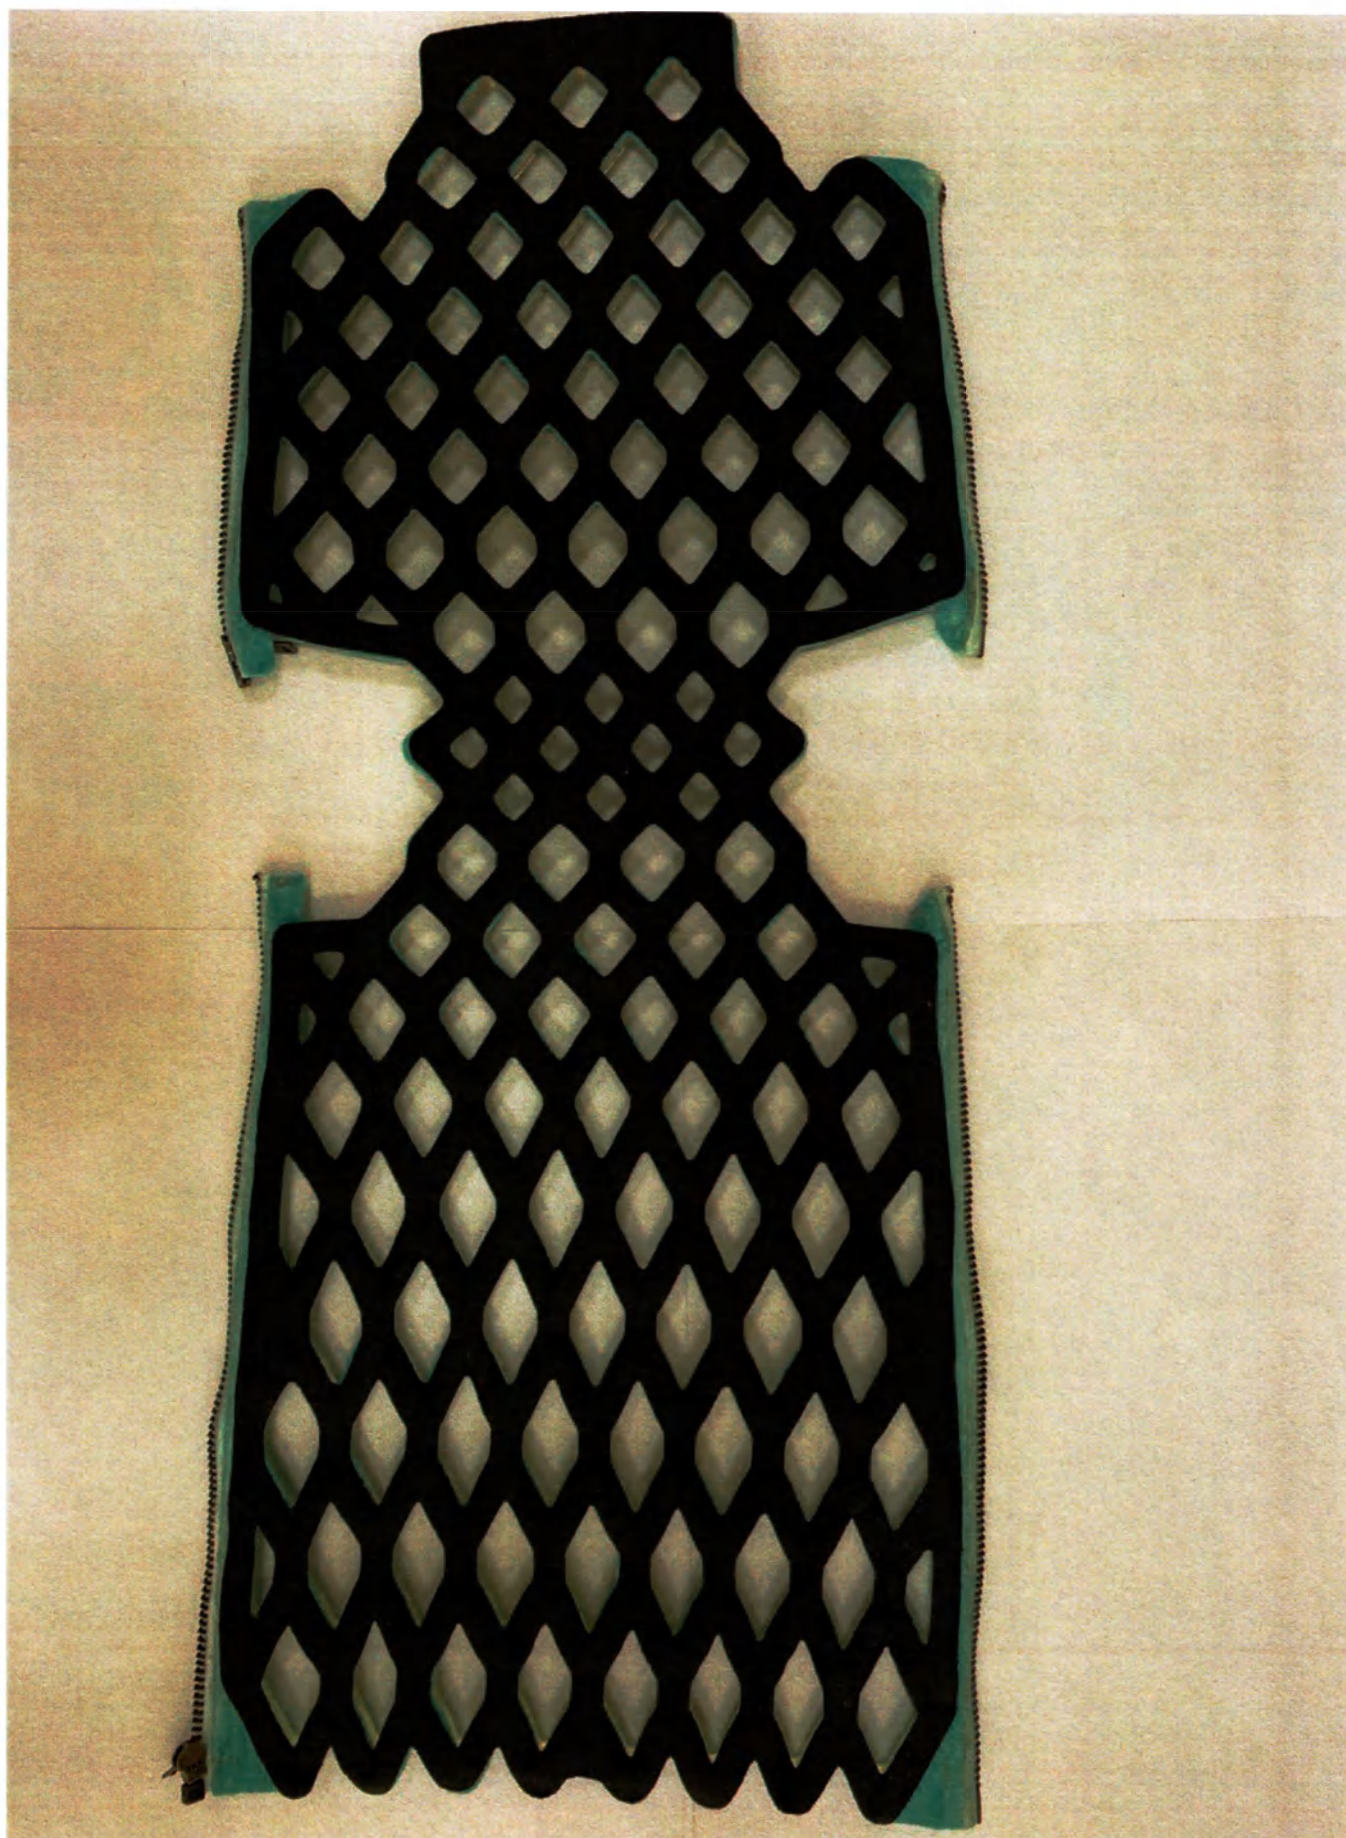


Рисунок 22. Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Вид изнутри)



Рисунок 23. Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Потребительская упаковка с маркировкой)


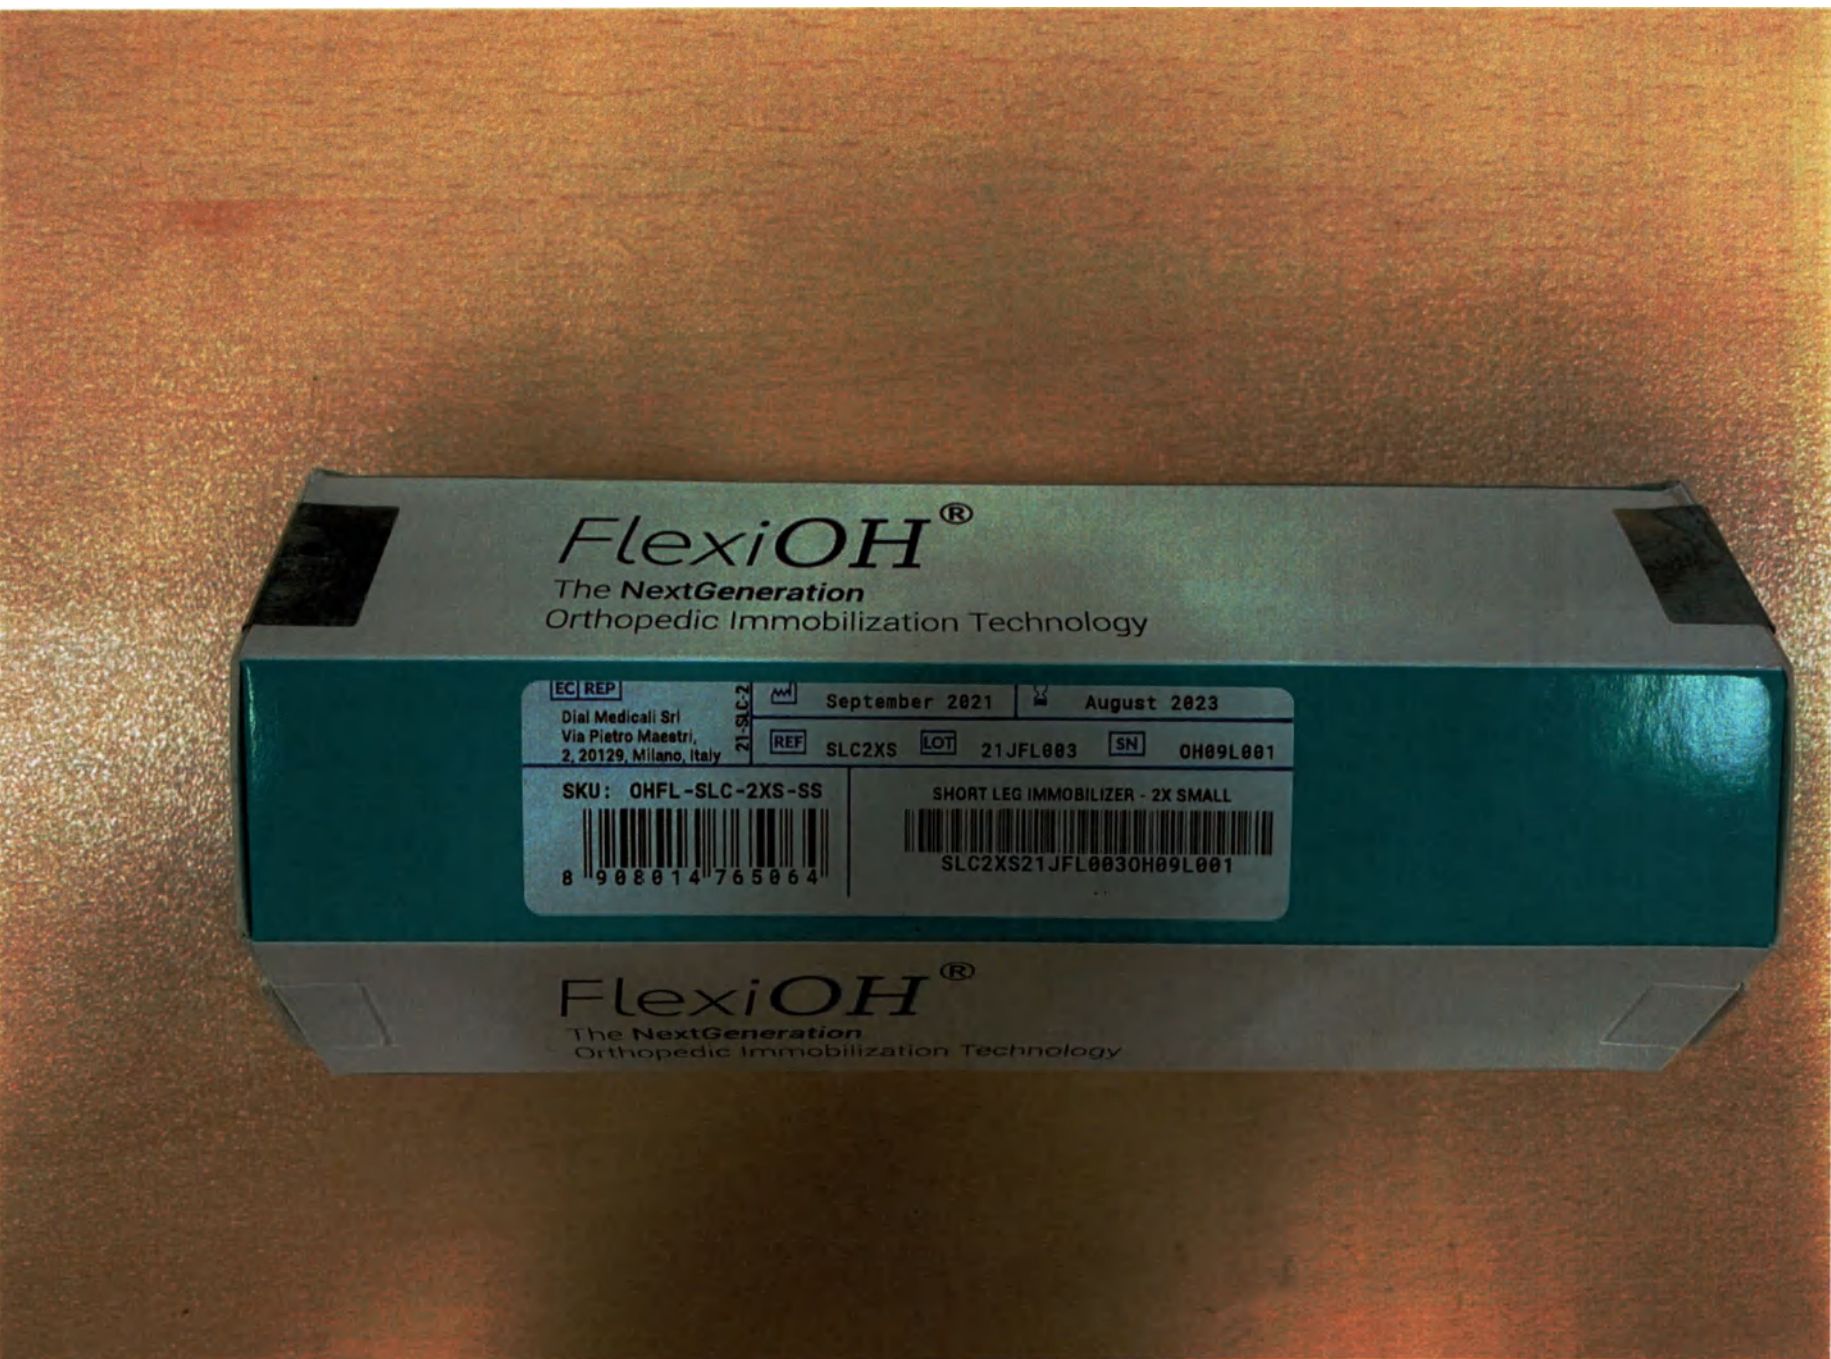


Рисунок 24 Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® на примере размера 2XS (Потребительская упаковка с маркировкой)



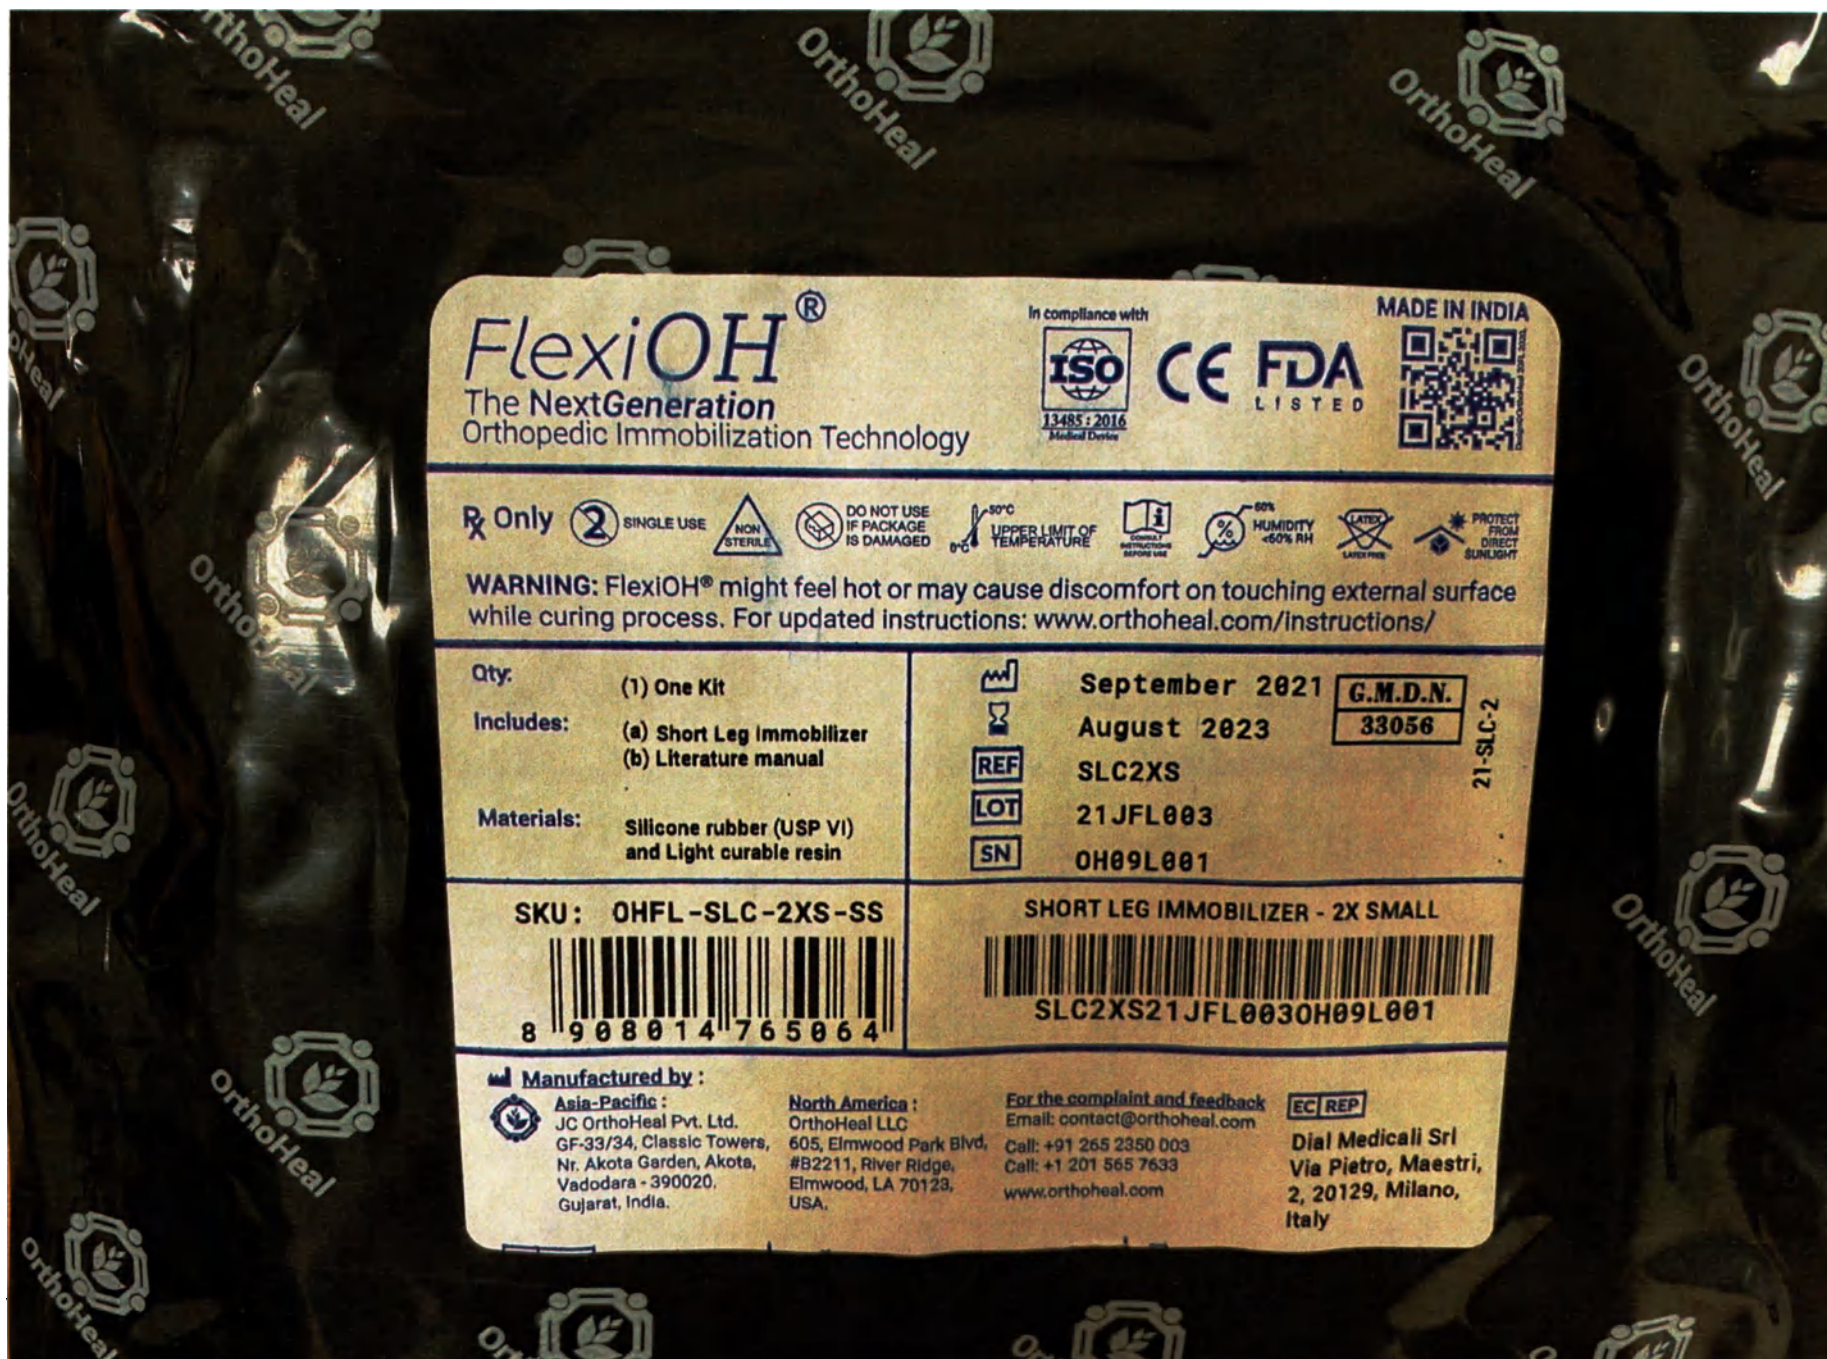

Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий)
FlexiON®**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 27 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiON®



Рисунок 28 Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® на примере размера М (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 29 Имobilизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® на примере размера М (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizeyCure®)

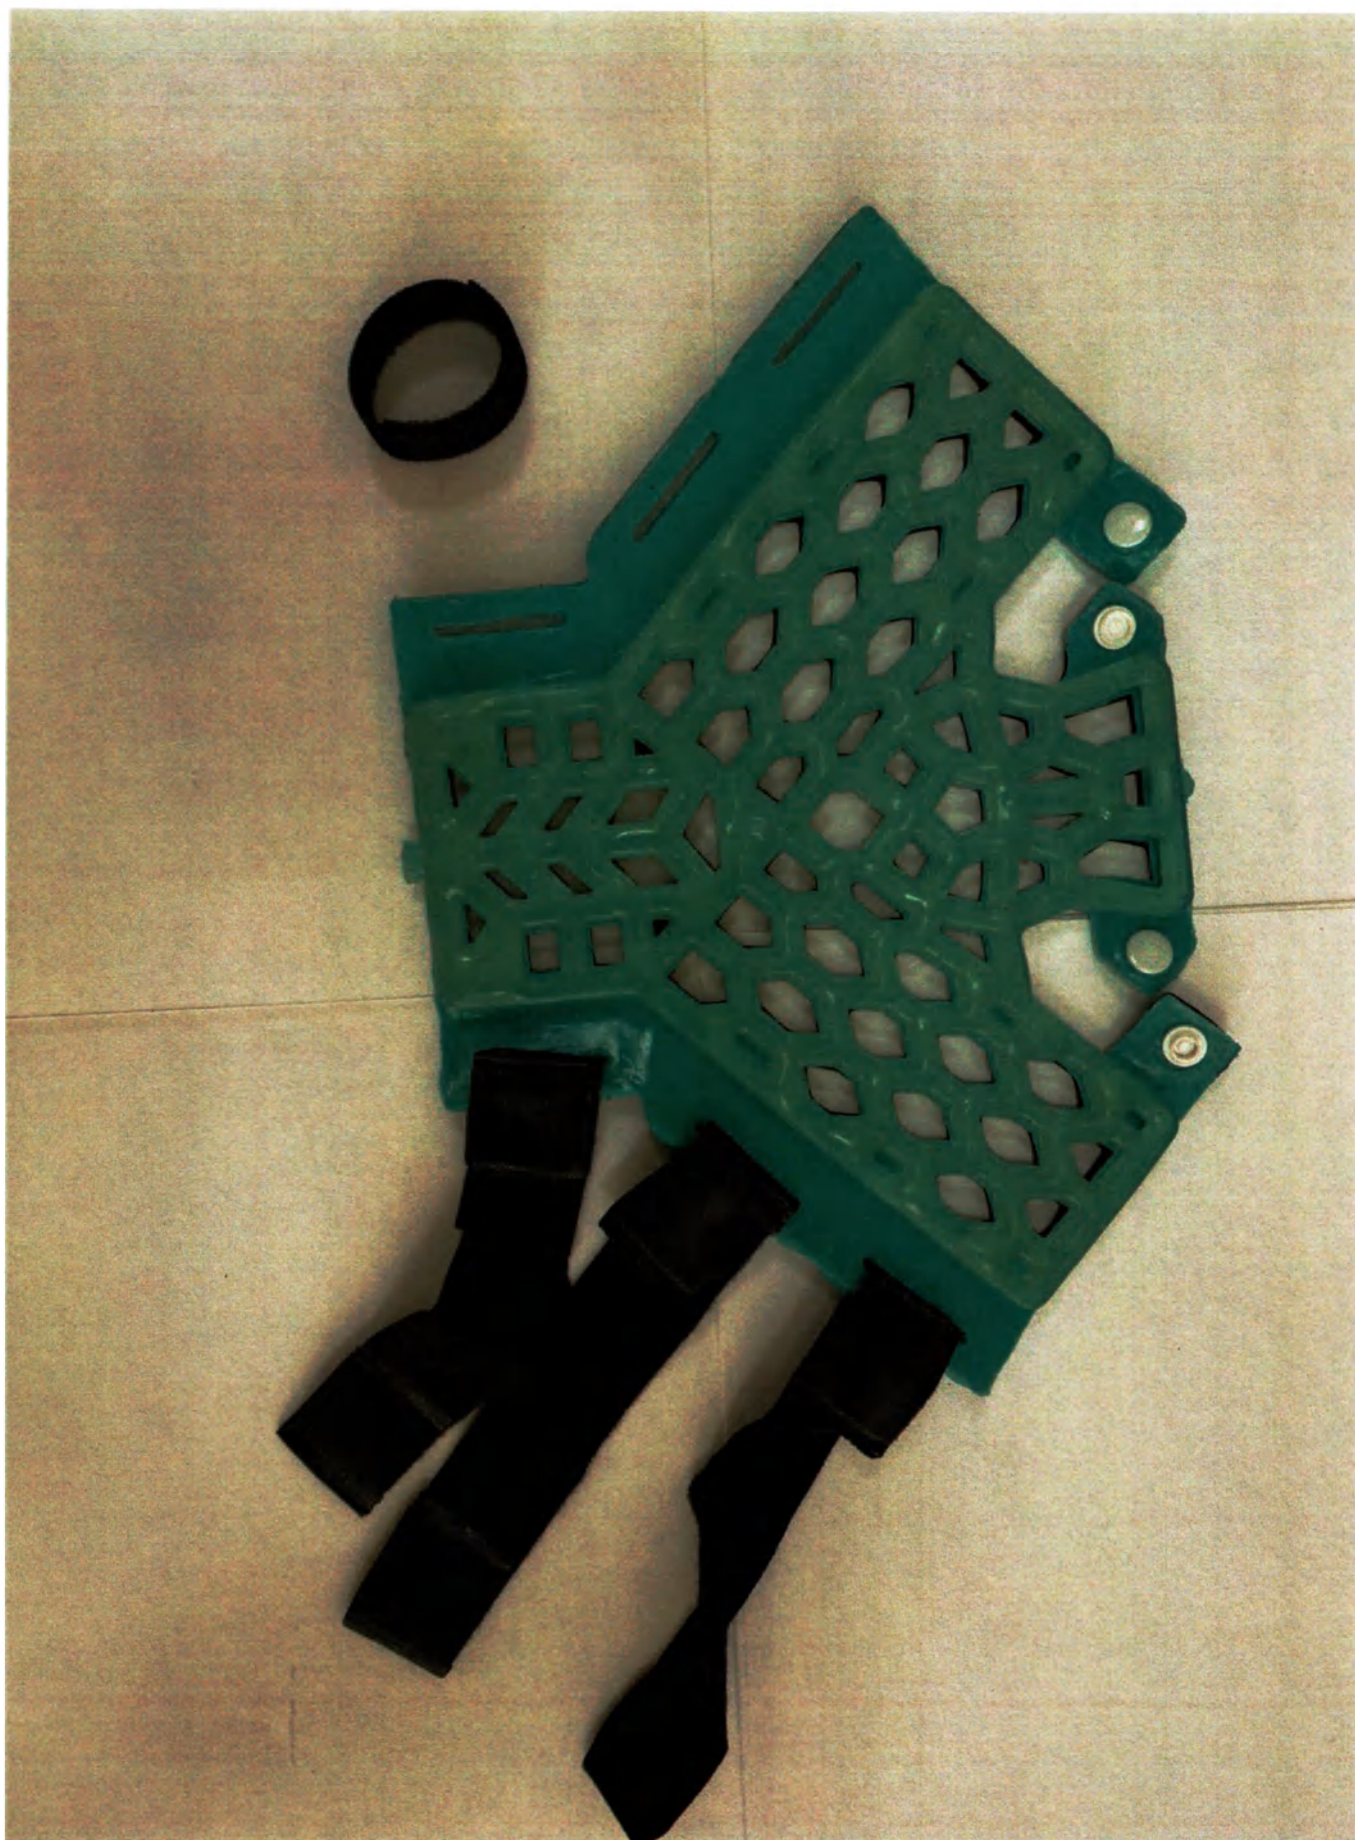


Рисунок 30. Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® на примере размера М (Вид снаружи)

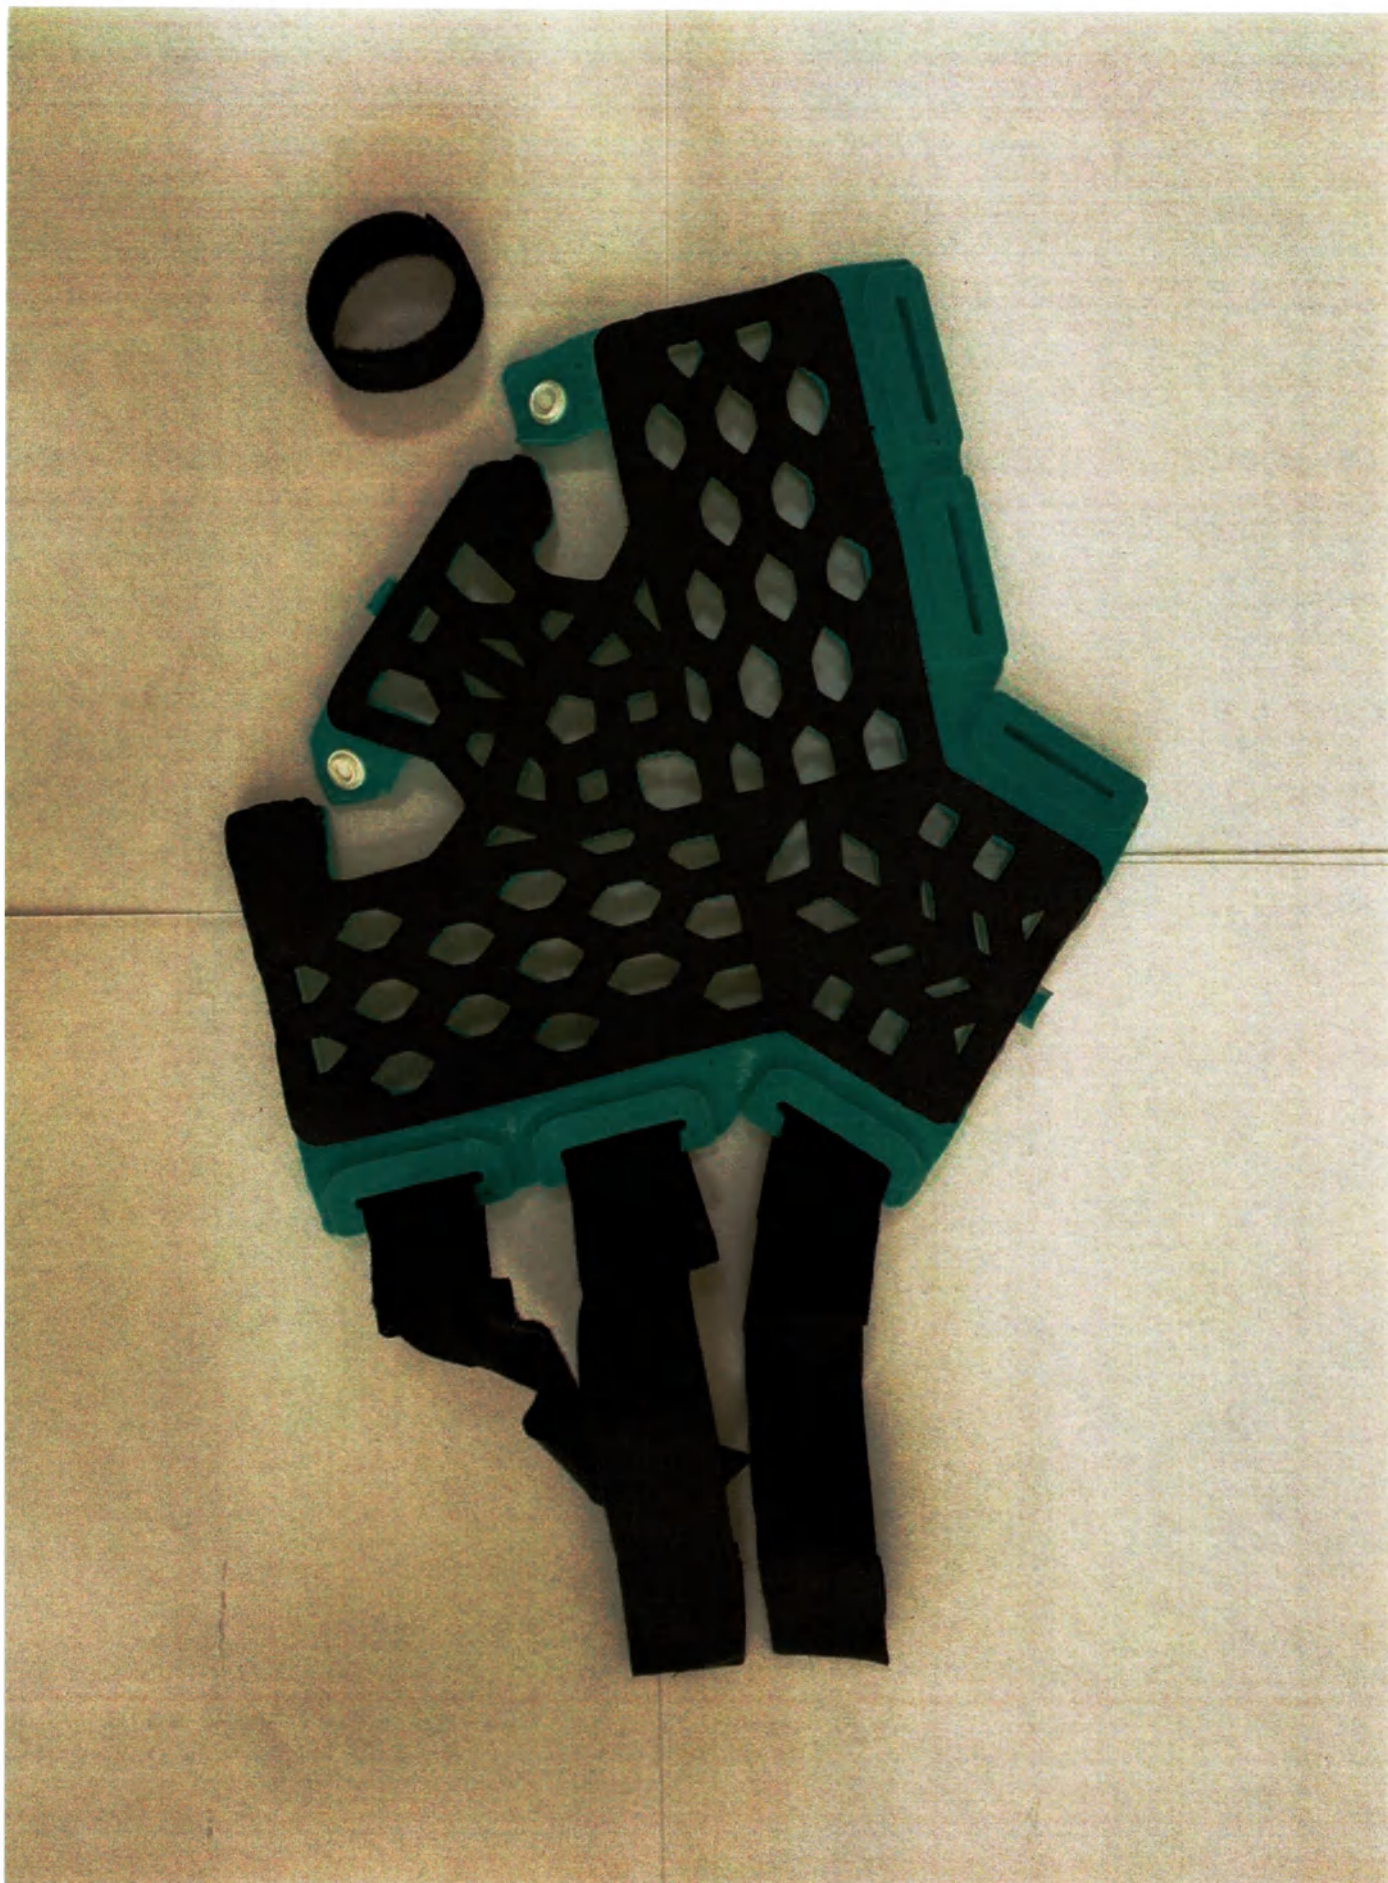


Рисунок 31. Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® на примере размера М (Вид изнутри)


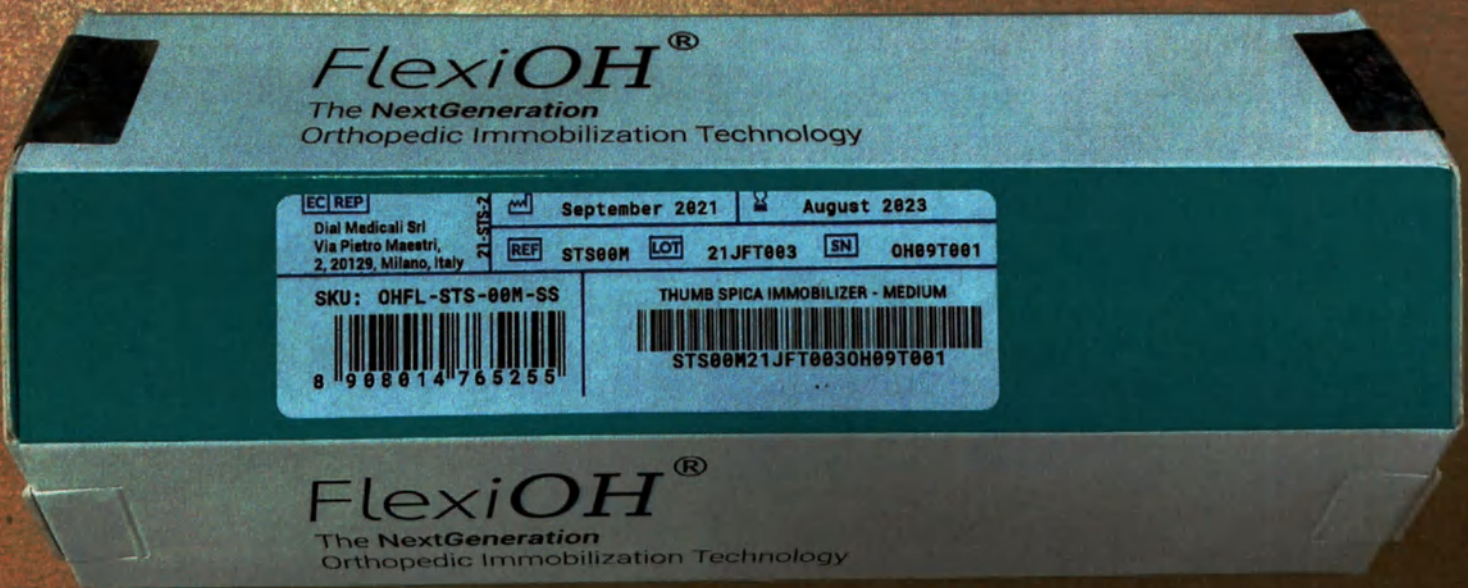


Рисунок 32. Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH[®] на примере размера M (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 33 Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® на примере размера М (Потребительская упаковка с маркировкой)



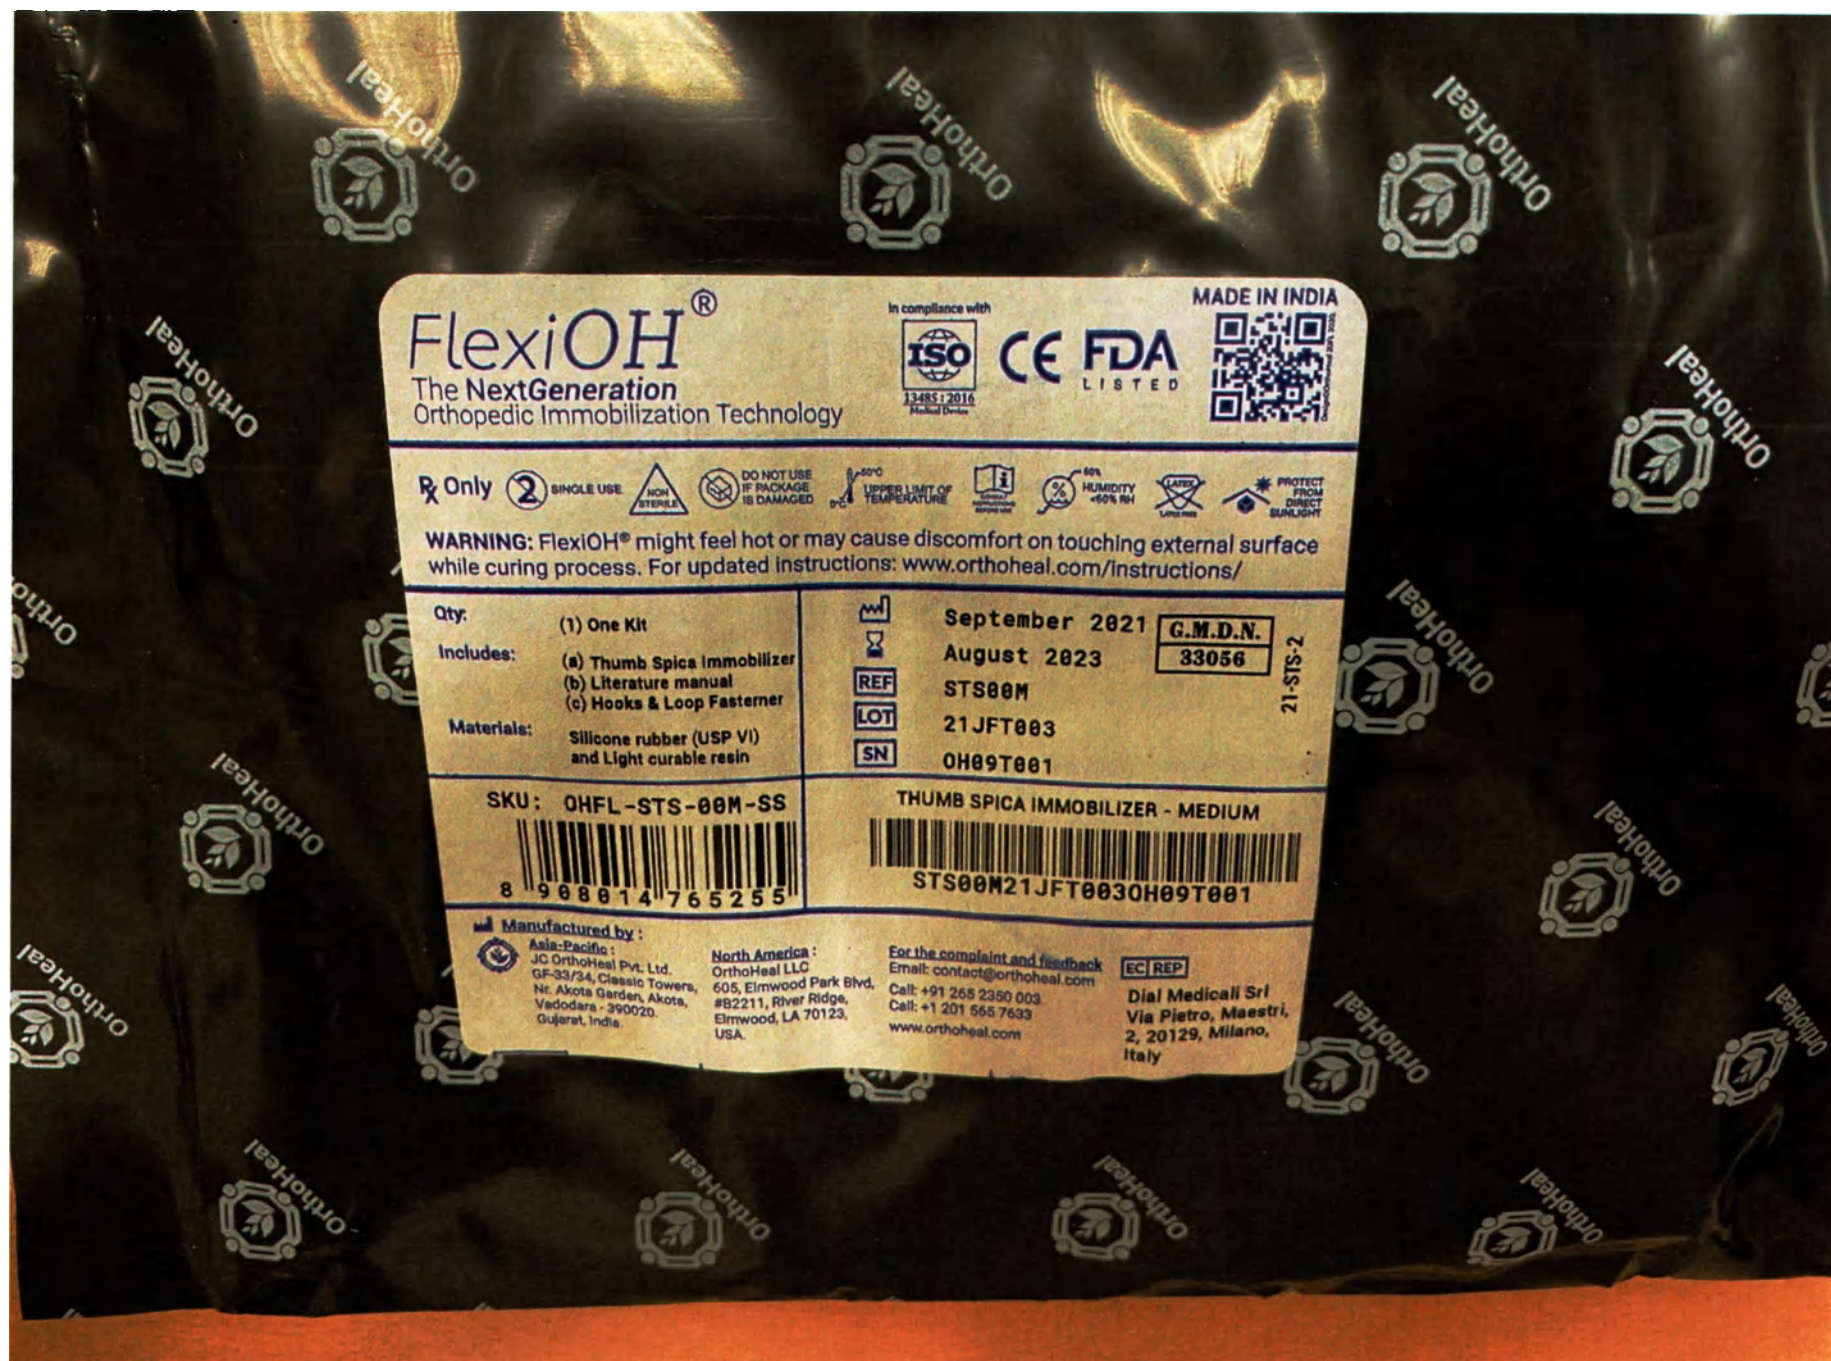

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для большого
пальца руки FlexiOH®**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 36 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH®

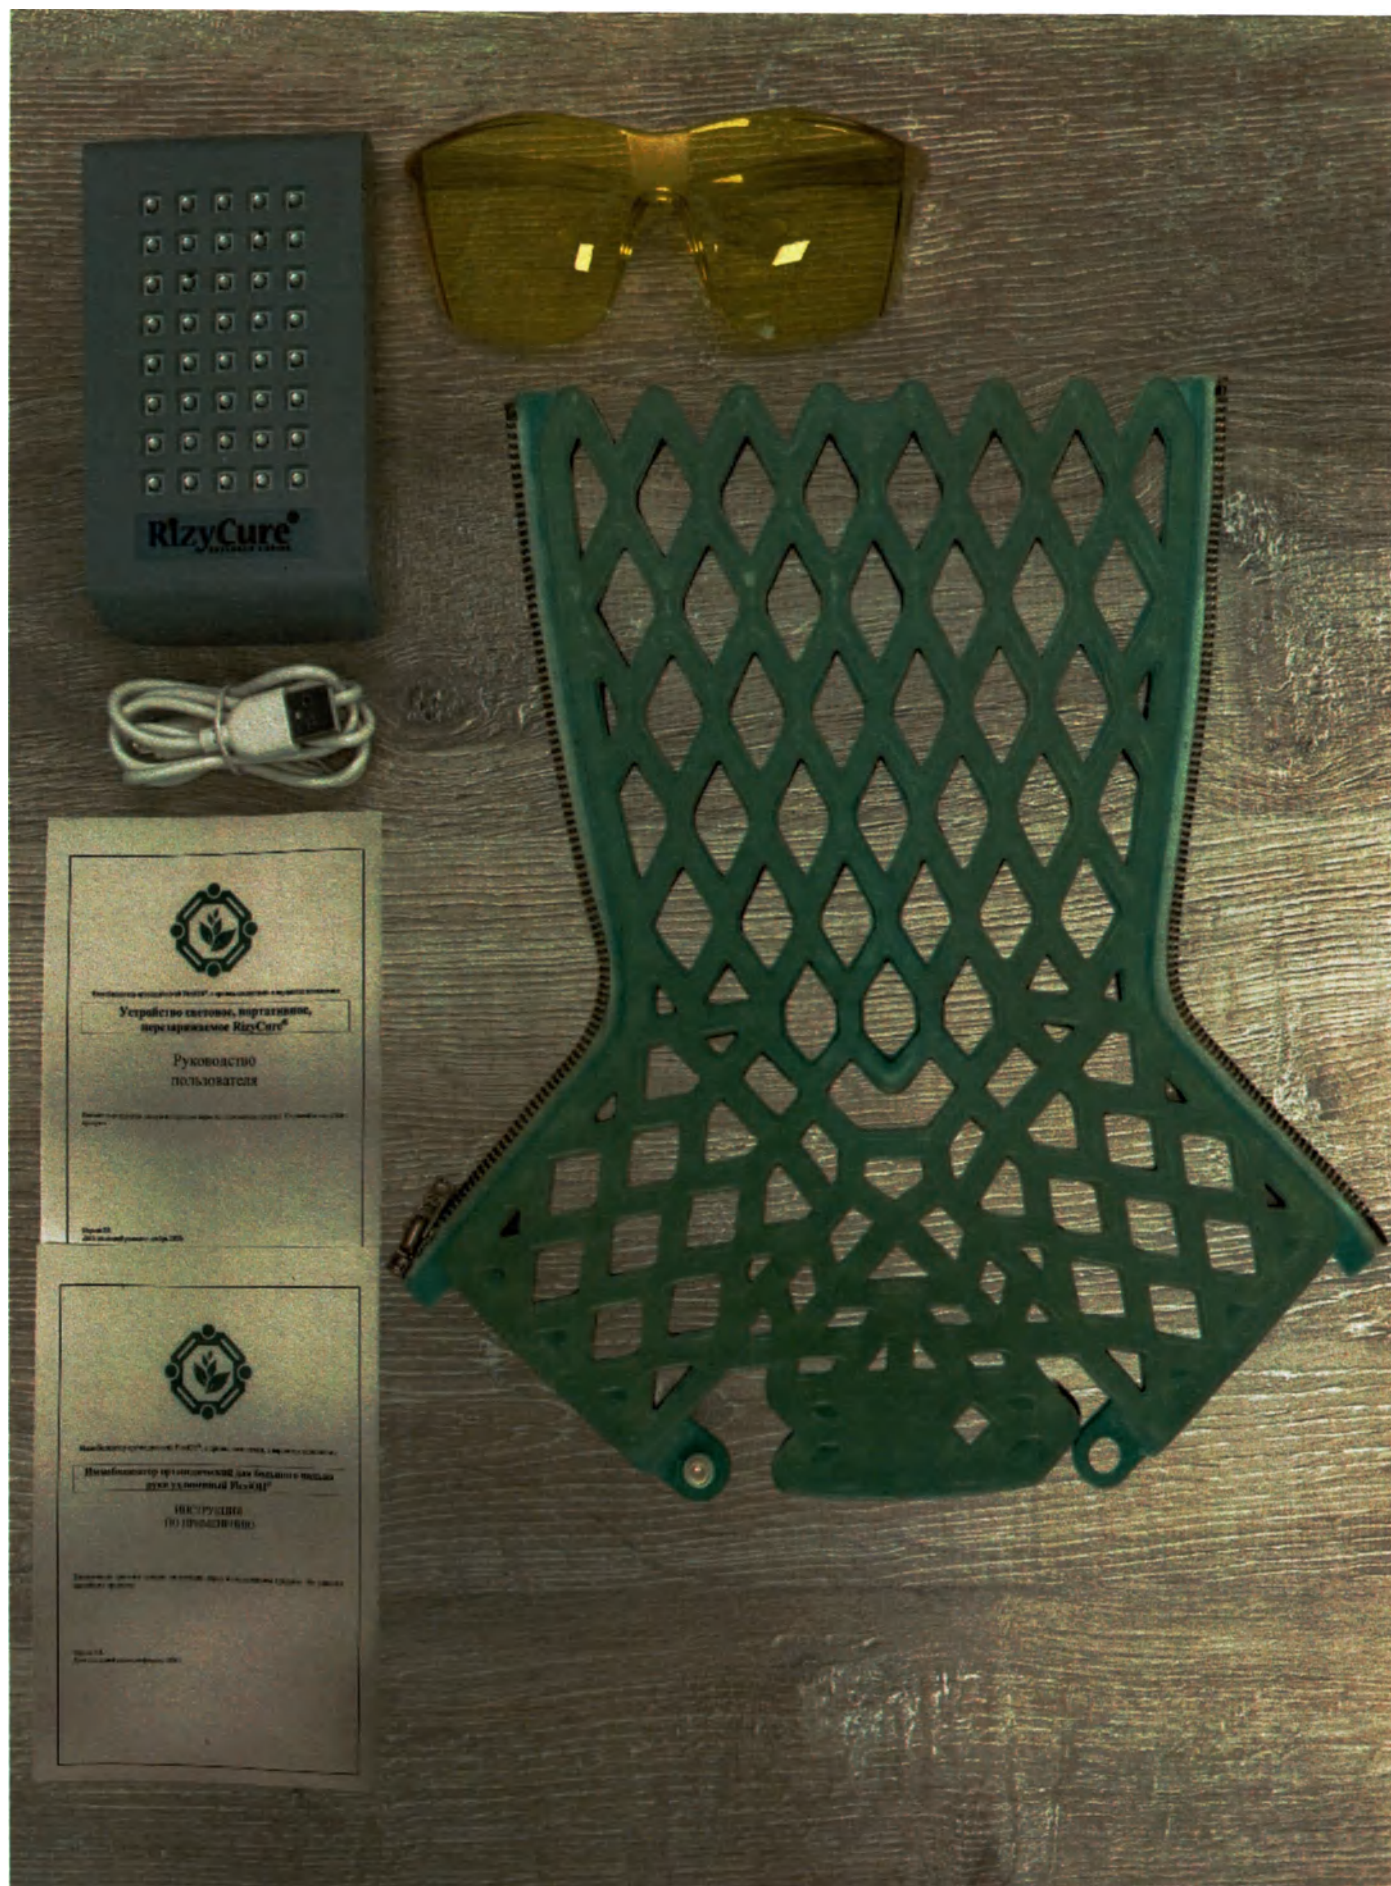


Рисунок 37 Имobilизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 38 Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®)

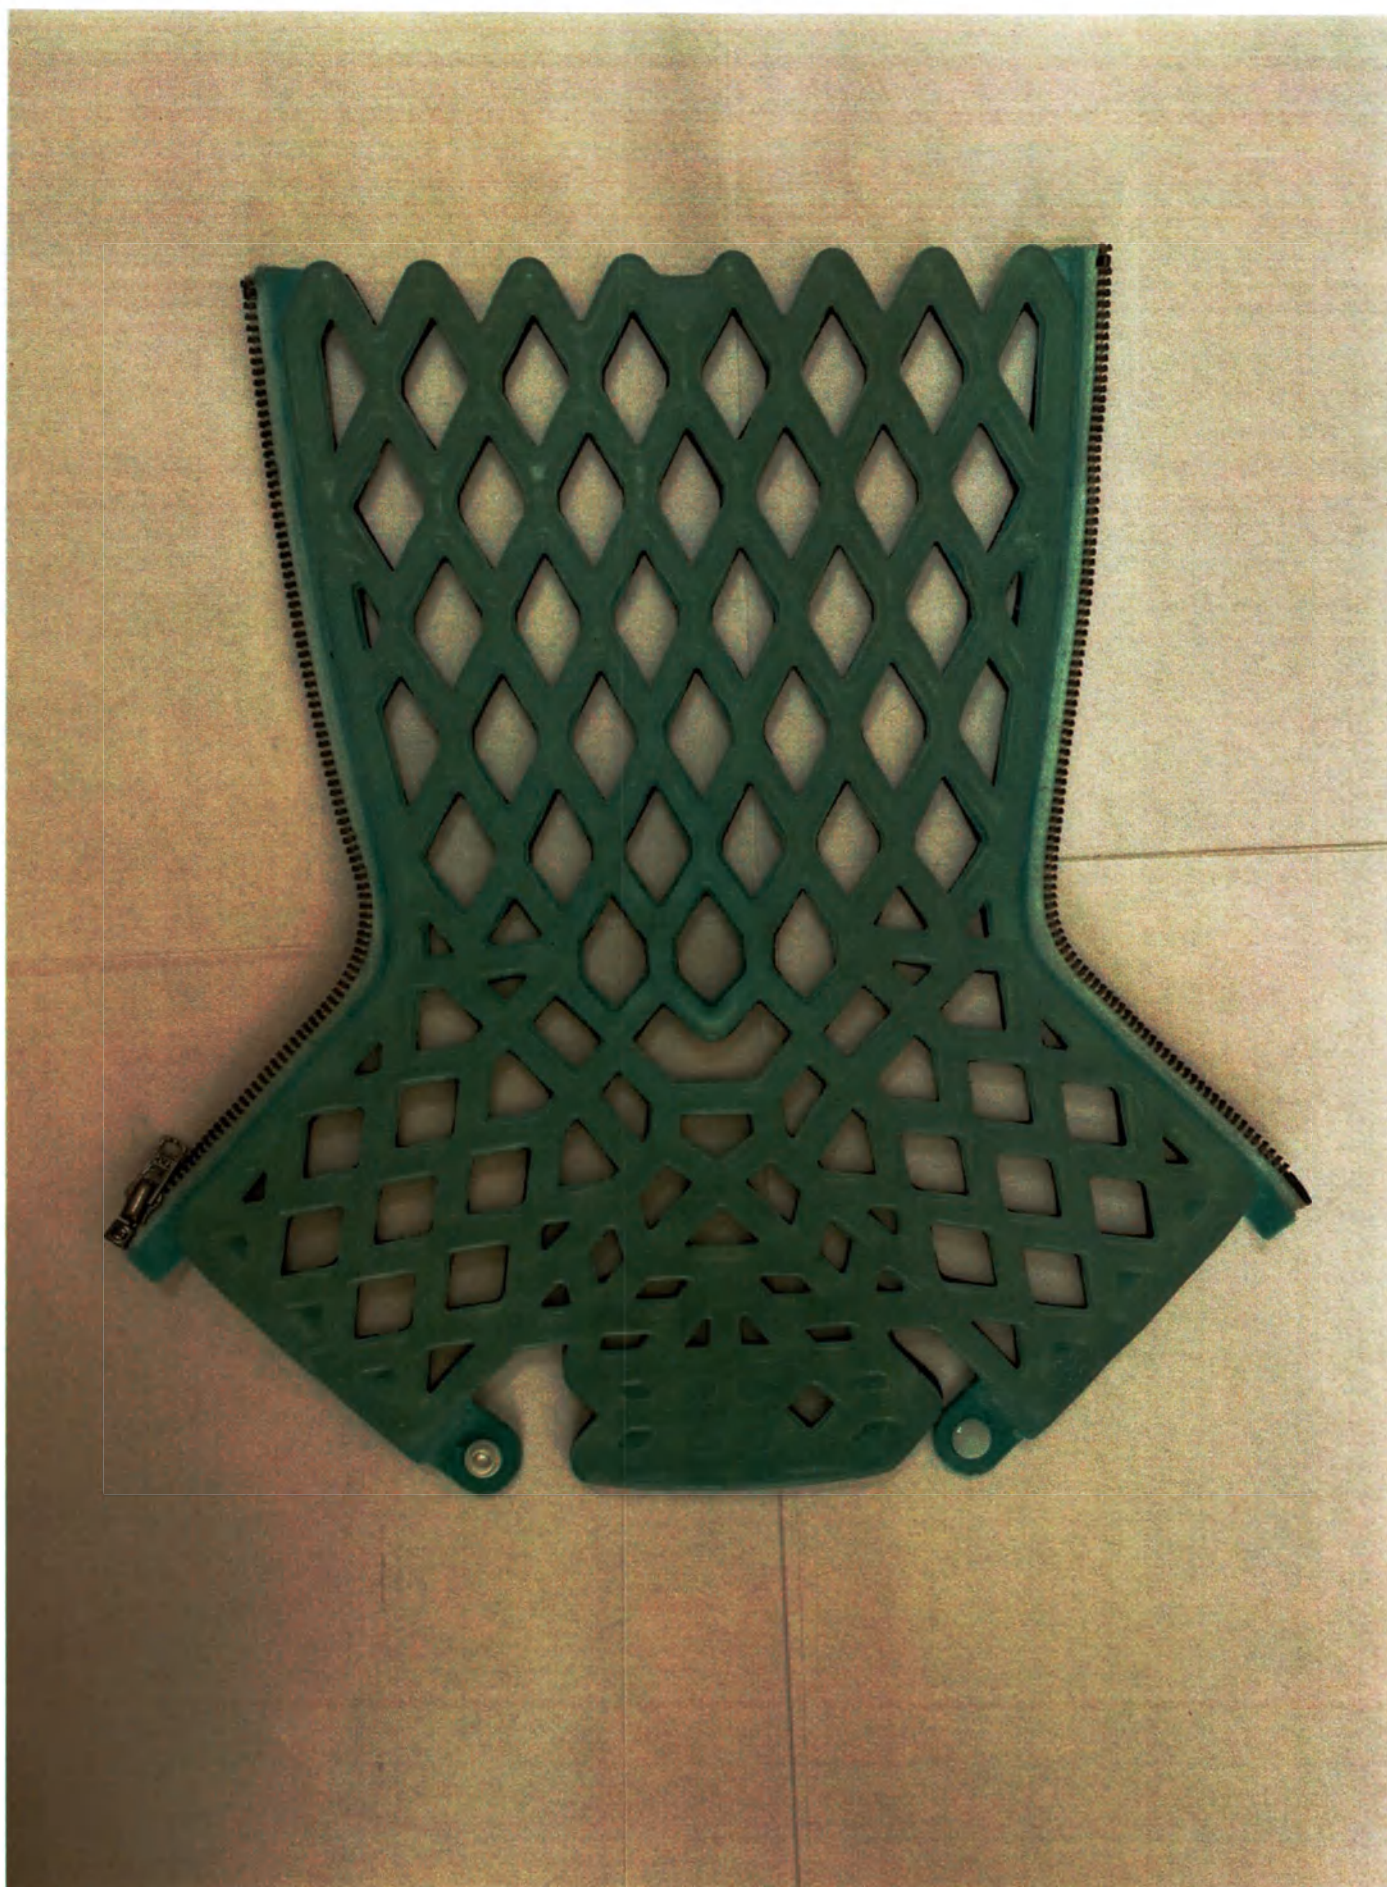


Рисунок 39. Имobilизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Вид снаружи)

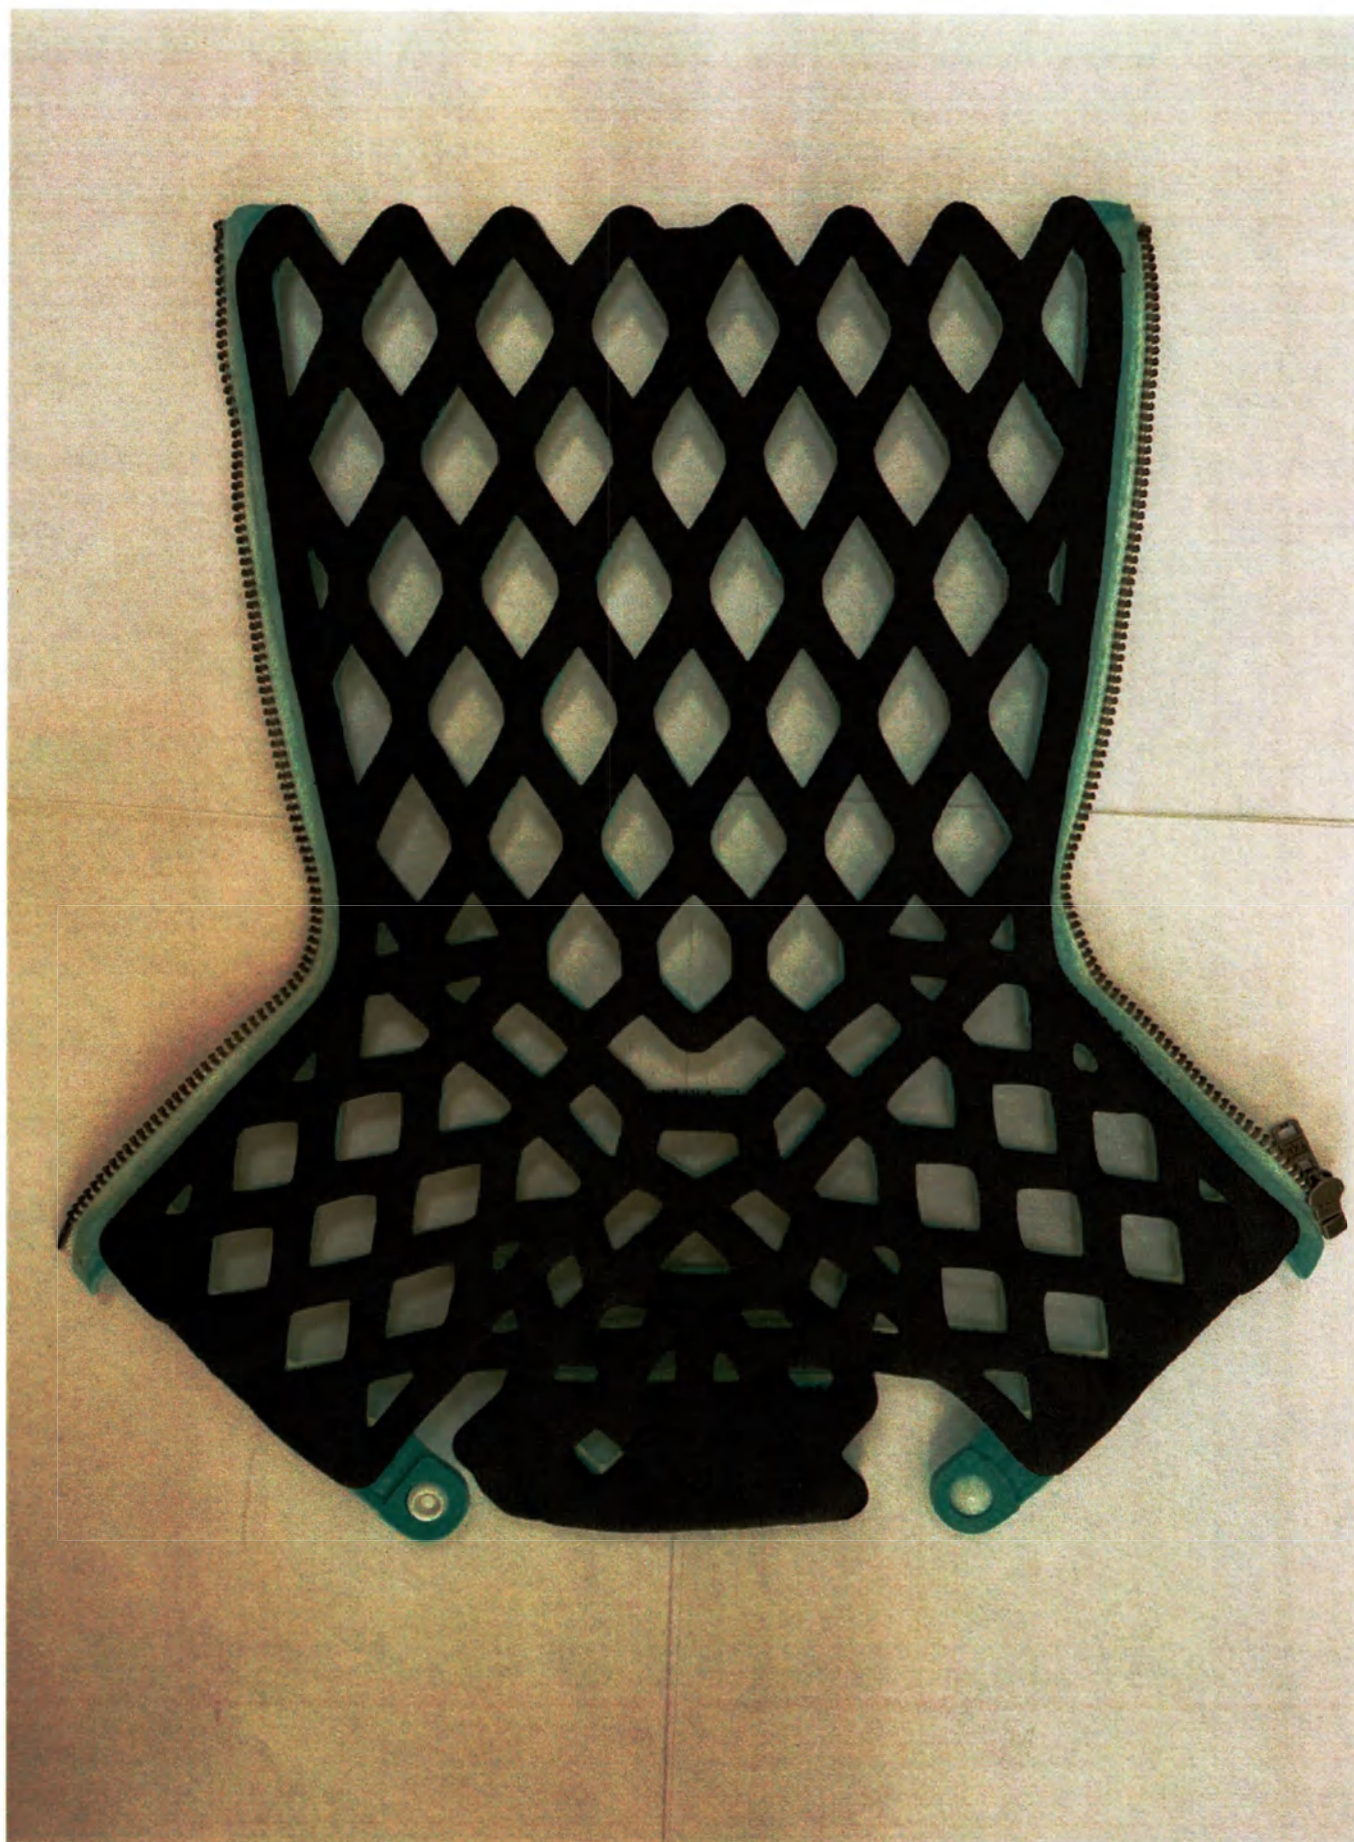


Рисунок 40. Имobilизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Вид изнутри)



Рисунок 41. Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 42 Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 43. Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки, (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Индивидуальная упаковка)



Рисунок 44 Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки, (удлиненный) FlexiOH® на примере размера L (Маркировка индивидуальной упаковки)



Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для большого пальца
руки удлиненный FlexiOH®**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 45 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки, (удлиненный) FlexiOH®



Рисунок 46 Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размер S (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 47 Имobilизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размер S (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizuCure®)

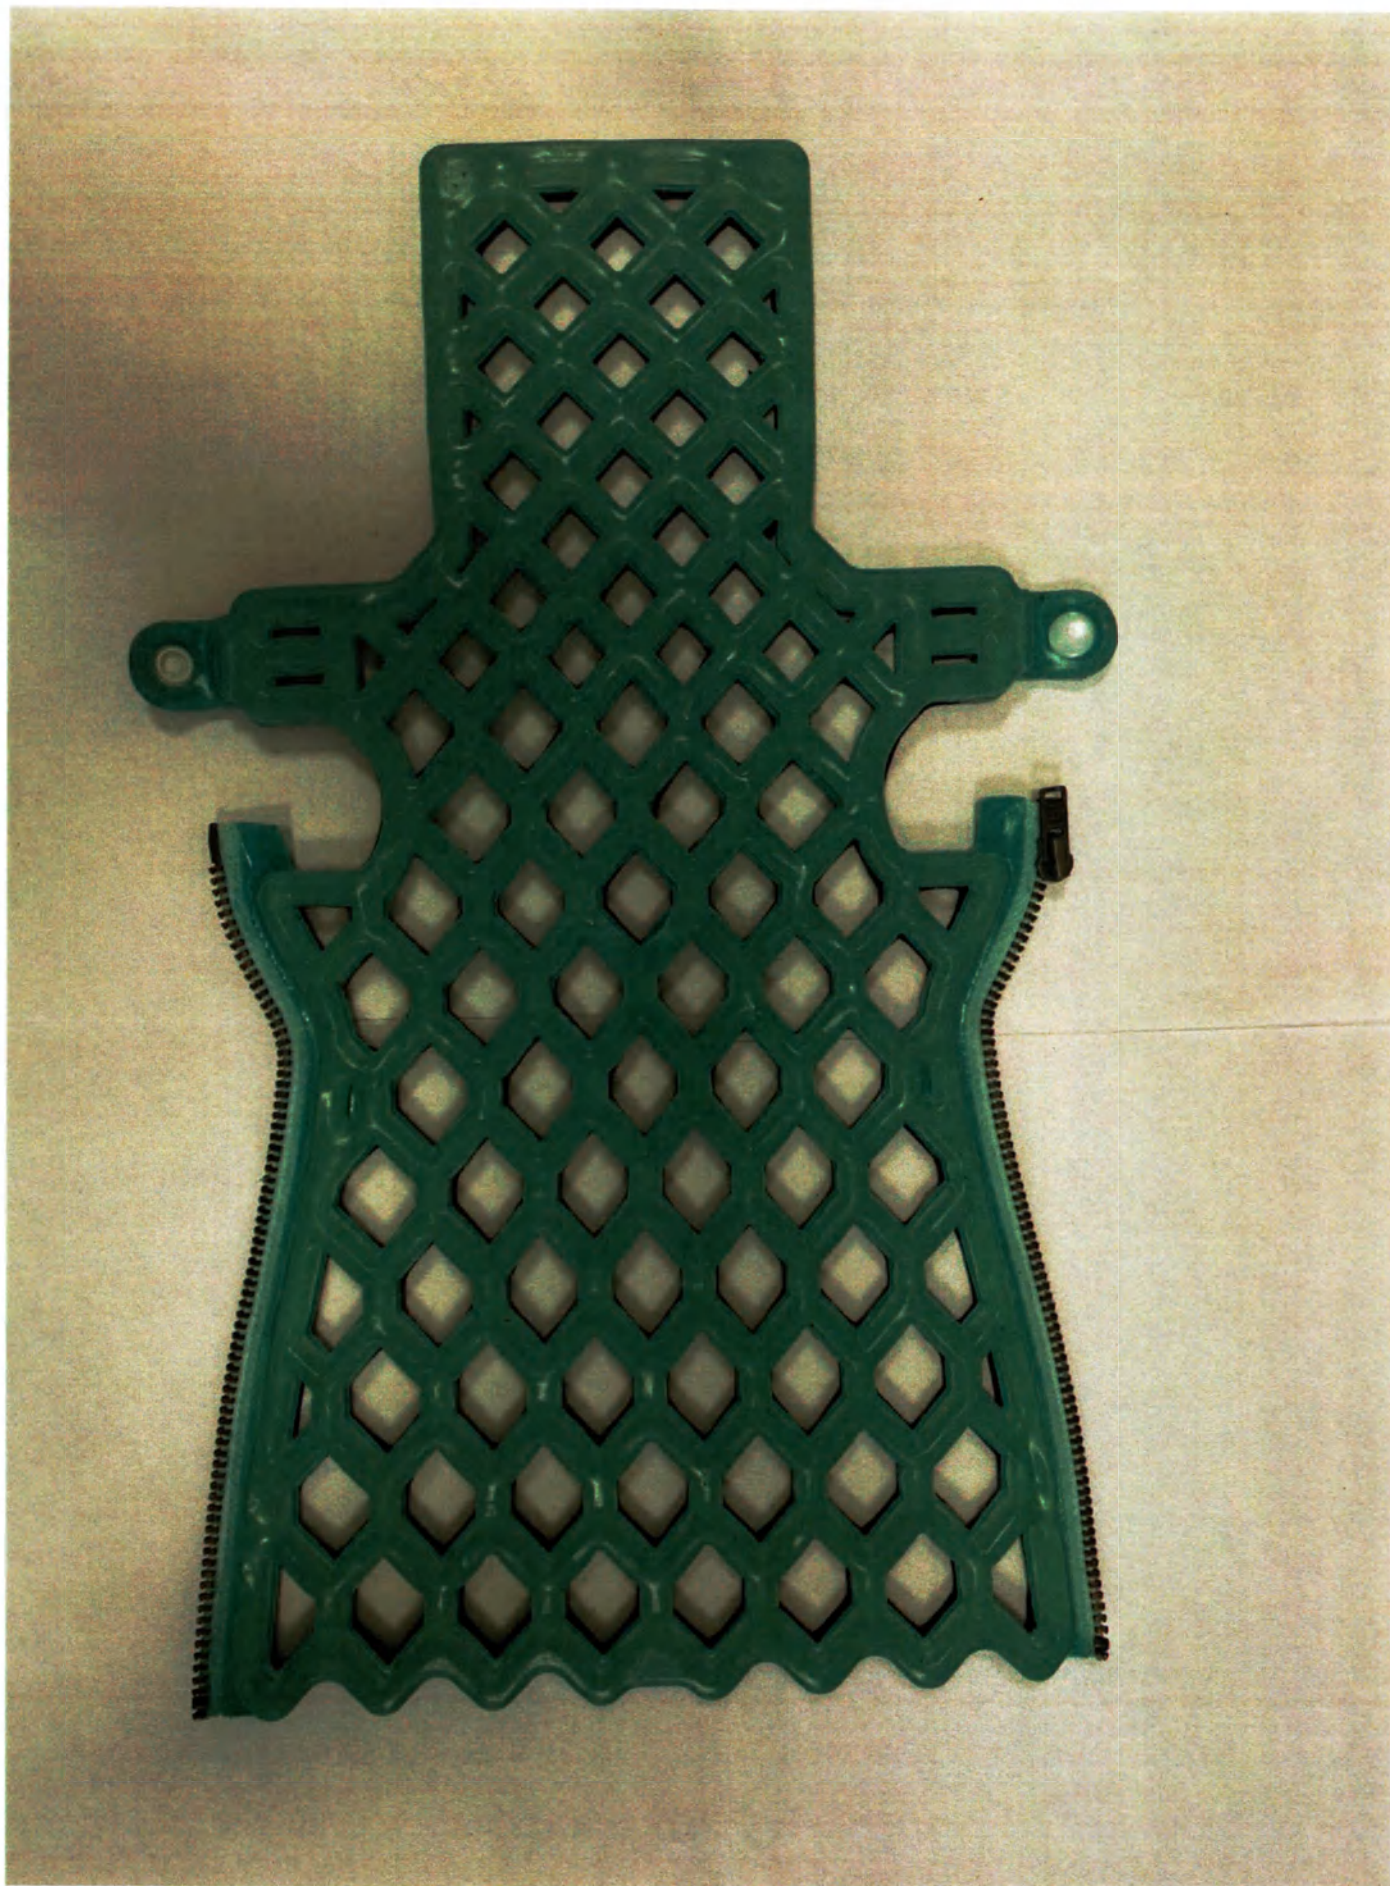


Рисунок 48. Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размер S (Вид снаружи)

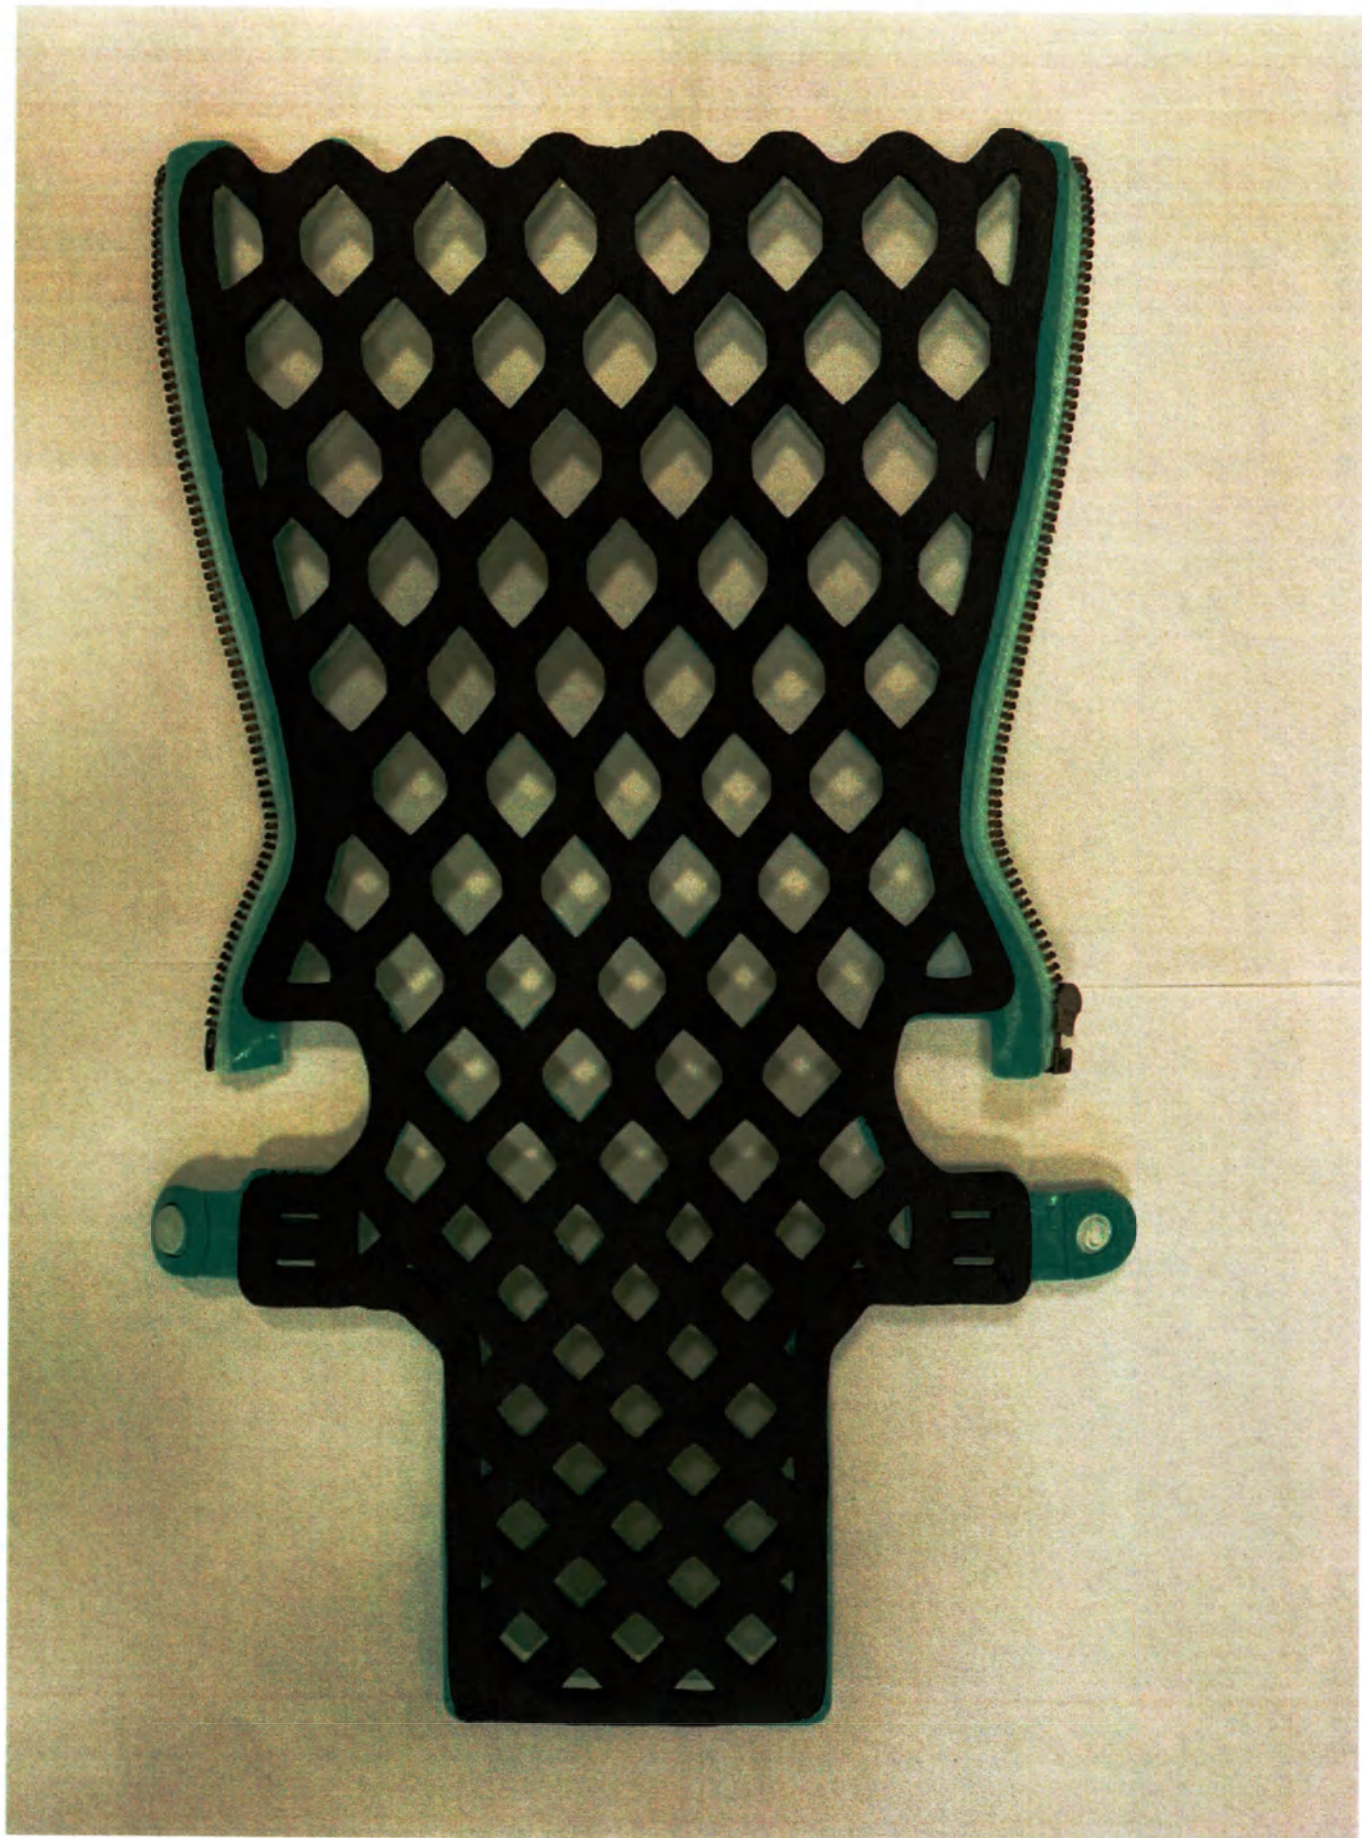


Рисунок 49. Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размер S (Вид изнутри)




Рисунок 50. Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размер S (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 51 Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунок 52. Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Индивидуальная упаковка)

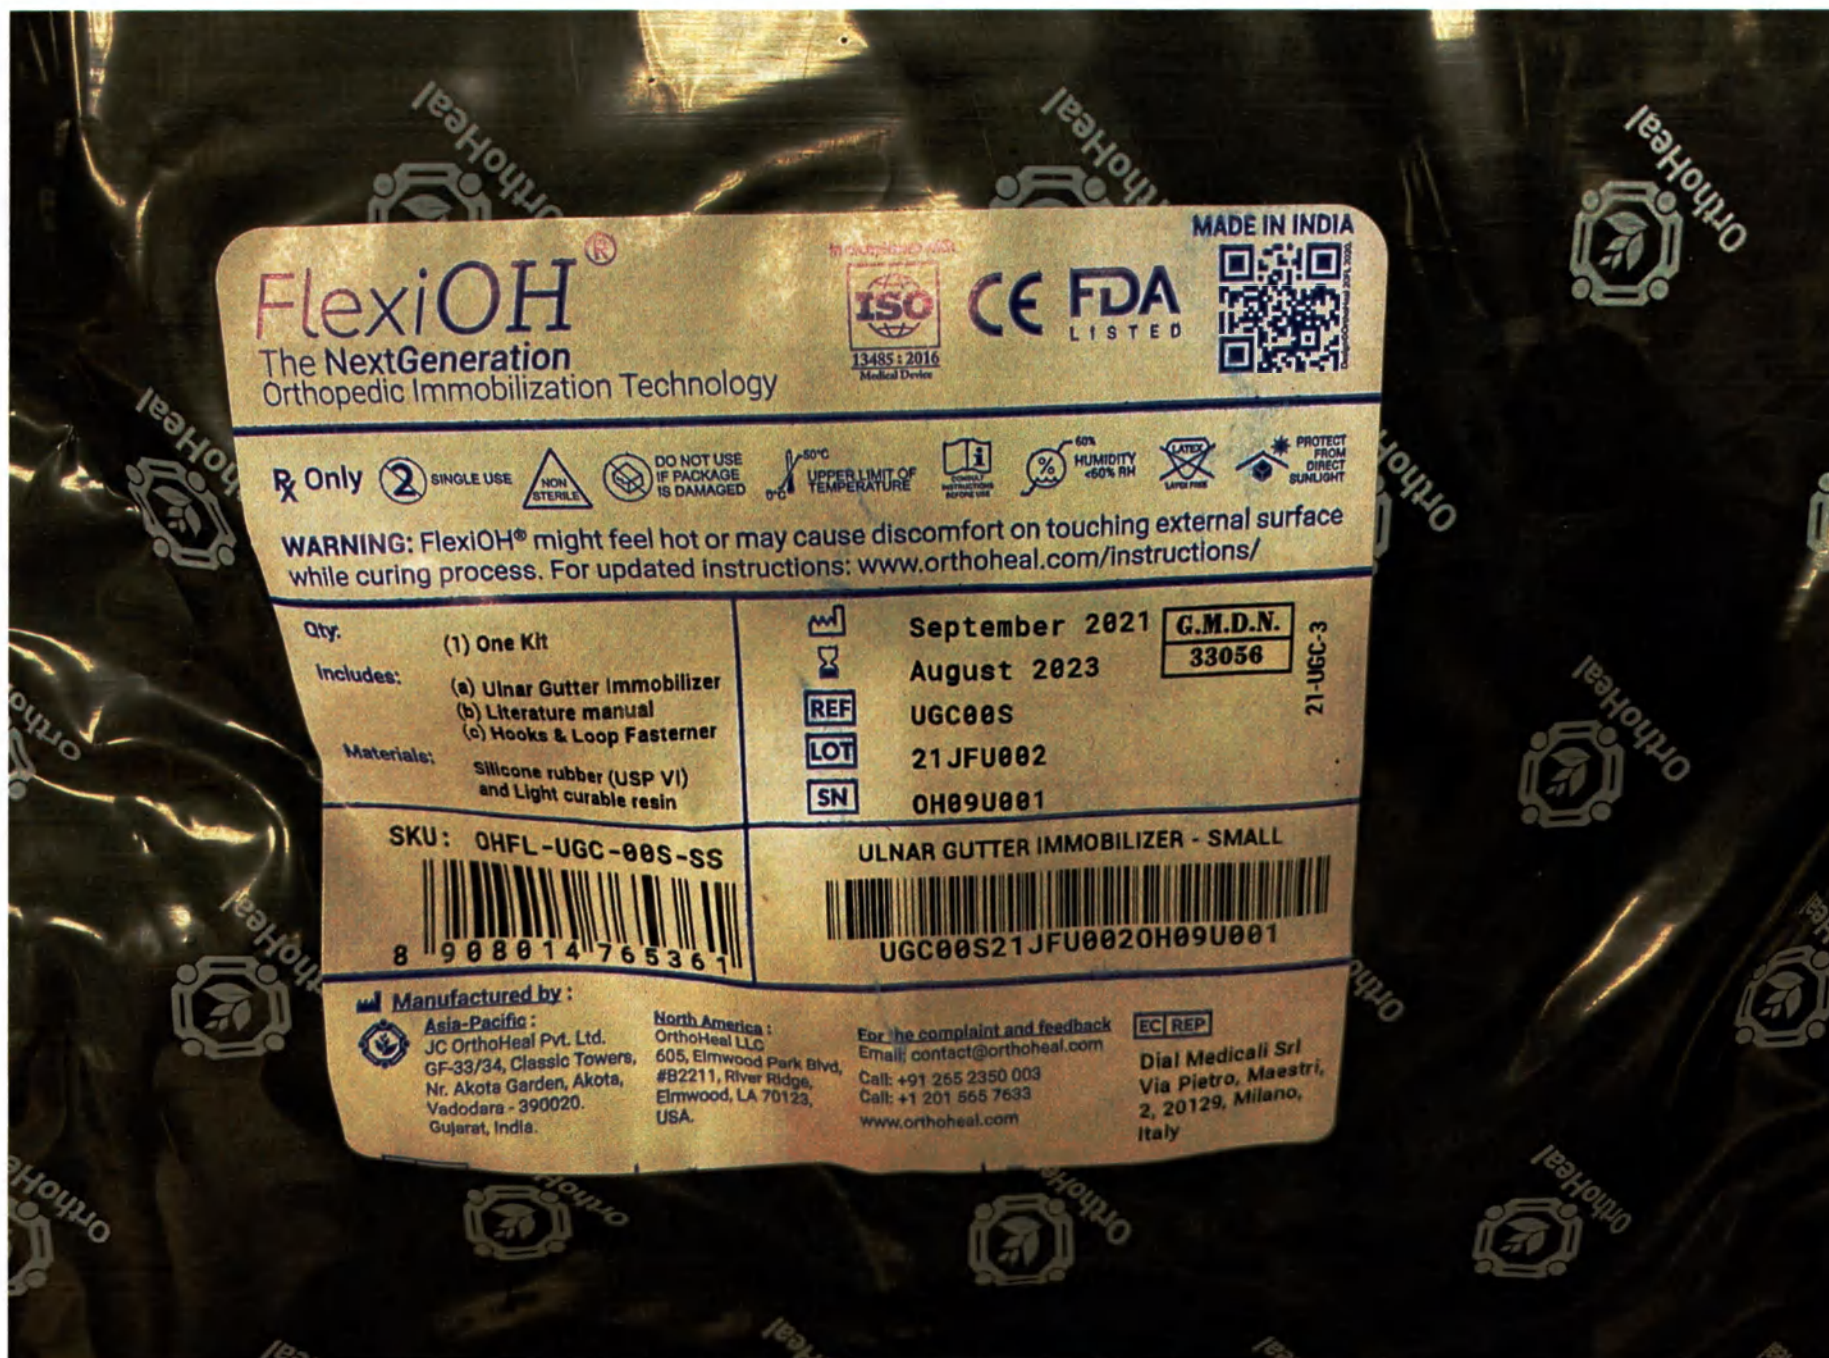



Иммобилизатор ортопедический FlexiOH[®], с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки
FlexiOH[®]**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 54 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH[®]



Рисунок 55 Имobilизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RzyCure®)



Рисунок 56 Имobilизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®)

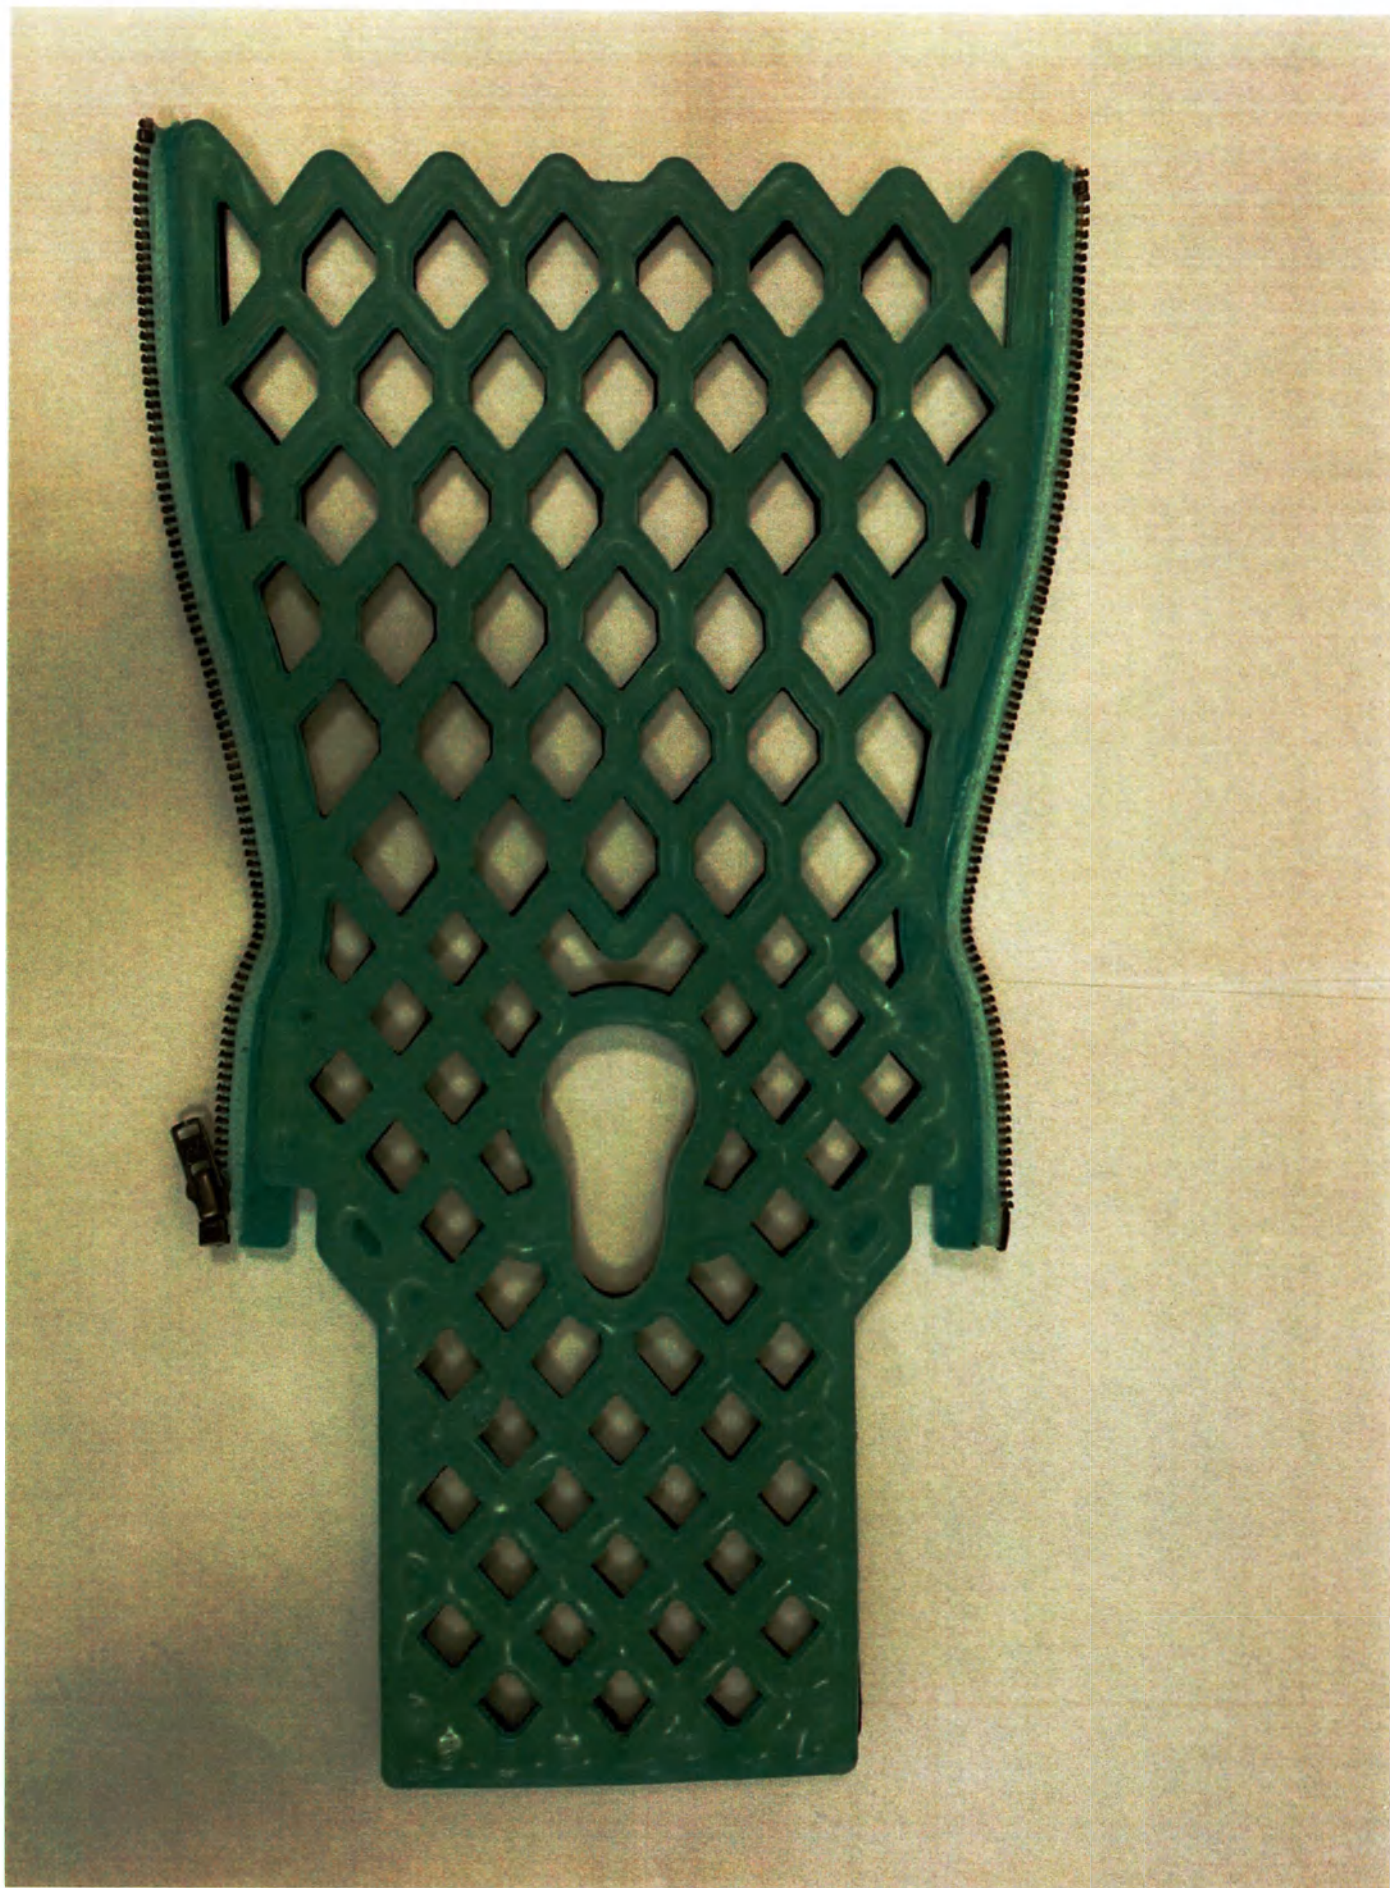


Рисунок 57. Имobilизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Вид снаружи)

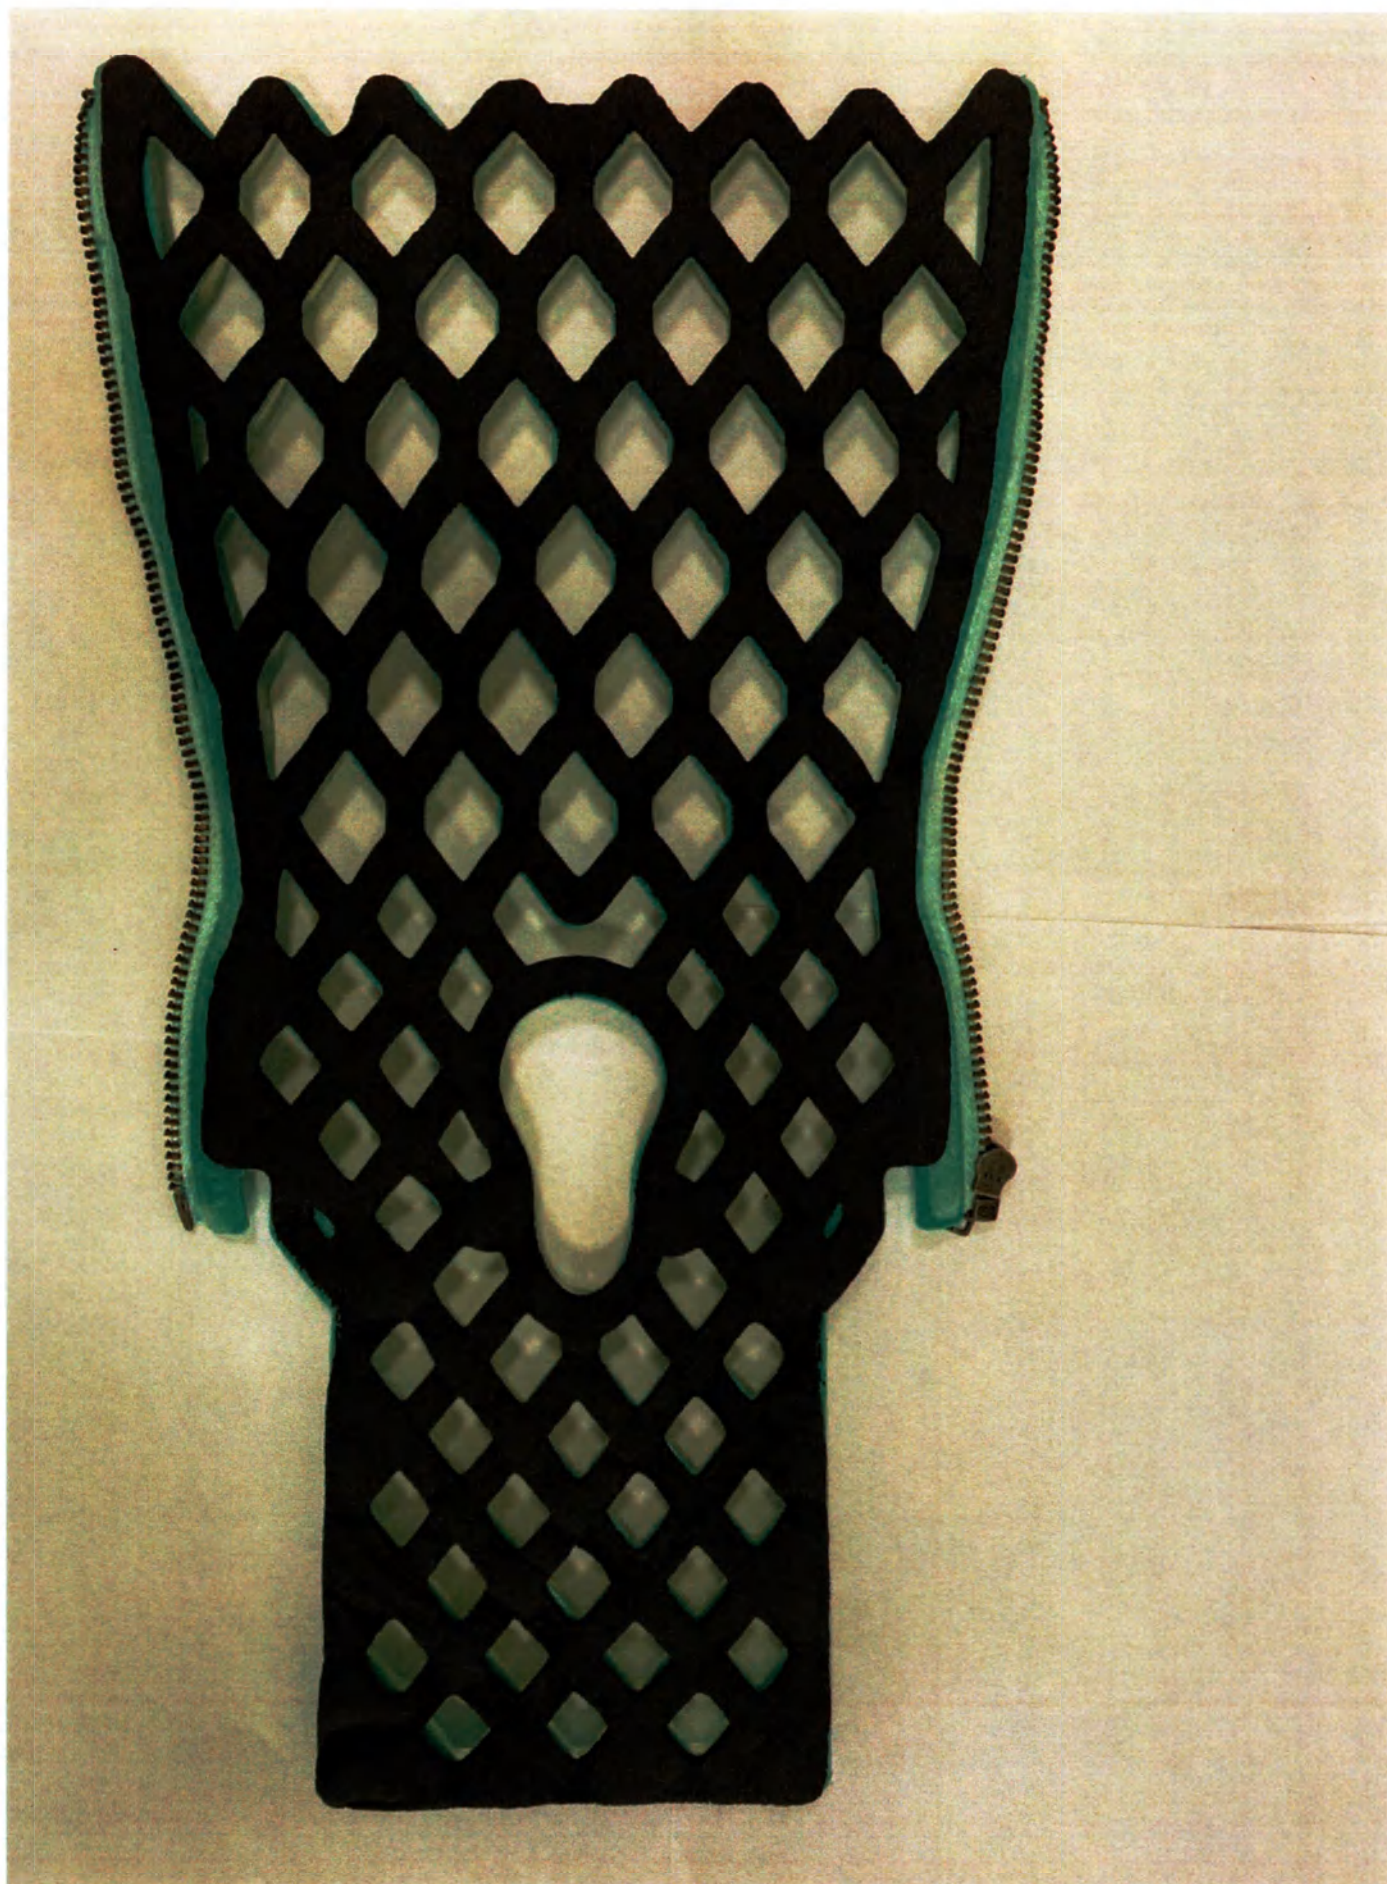


Рисунок 58. Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Вид изнутри)



Рисунок 59. Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Потребительская упаковка с маркировкой)



Рисунки 60 Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® на примере размера S (Потребительская упаковка с маркировкой)

FlexiOH®
The NextGeneration
Orthopedic Immobilization Technology

In compliance with
ISO 13485:2016 Medical Device
CE **FDA** LISTED
MADE IN INDIA

Rx Only **2** SINGLE USE **NON STERILE** **DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED** **UPPER LIMIT OF TEMPERATURE** **60°C** **60% HUMIDITY** **PROTECT FROM DIRECT SUNLIGHT**

WARNING: FlexiOH® might feel hot or may cause discomfort on touching external surface while curing process. For updated instructions: www.orthoheal.com/instructions/

Qty: (1) One Kit	September 2021 G.M.D.N.
Includes: (a) Radial Gutter Immobilizer (b) Literature manual (c) Hooks & Loop Fastener	August 2023 33056
Materials: Silicone rubber (USP VI) and Light curable resin	REF RGC00S LOT 21JFR002 SN OH09R001

21-RGC-3

SKU: OHFL-RGC-00S-SS 8 908014765323	RADIAL GUTTER IMMOBILIZER - SMALL RGC00S21JFR002OH09R001
--	---

Manufactured by:
Asia-Pacific:
 JC OrthoHeal Pvt. Ltd.
 GF-33/34, Classic Towers,
 Nr. Akota Garden, Akota,
 Vadodra - 390020,
 Gujarat, India.
North America:
 OrthoHeal LLC
 605, Elmwood Park Blvd,
 #B2211, River Ridge,
 Elmwood, LA 70123,
 USA.
For the complaint and feedback
 Email: contact@orthoheal.com
 Call: +91 265 2350 003
 Call: +1 201 565 7633
www.orthoheal.com
EC REP
 Dial Medicali Srl
 Via Pietro, Maestri,
 2, 20129, Milano,
 Italy



Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

**Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или
II и III пальца руки FlexiON®**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 3.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 63 Инструкция по применению для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiON®



Рисунок 64: Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3х9 дюймов (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®)



Рисунок 65 Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3х9 дюймов (Общий вид медицинского изделия с принадлежностью Устройство световое для полимеризации, проводное RizuCure®)



Рисунок 66. Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3x9 дюймов (Вид снаружи)

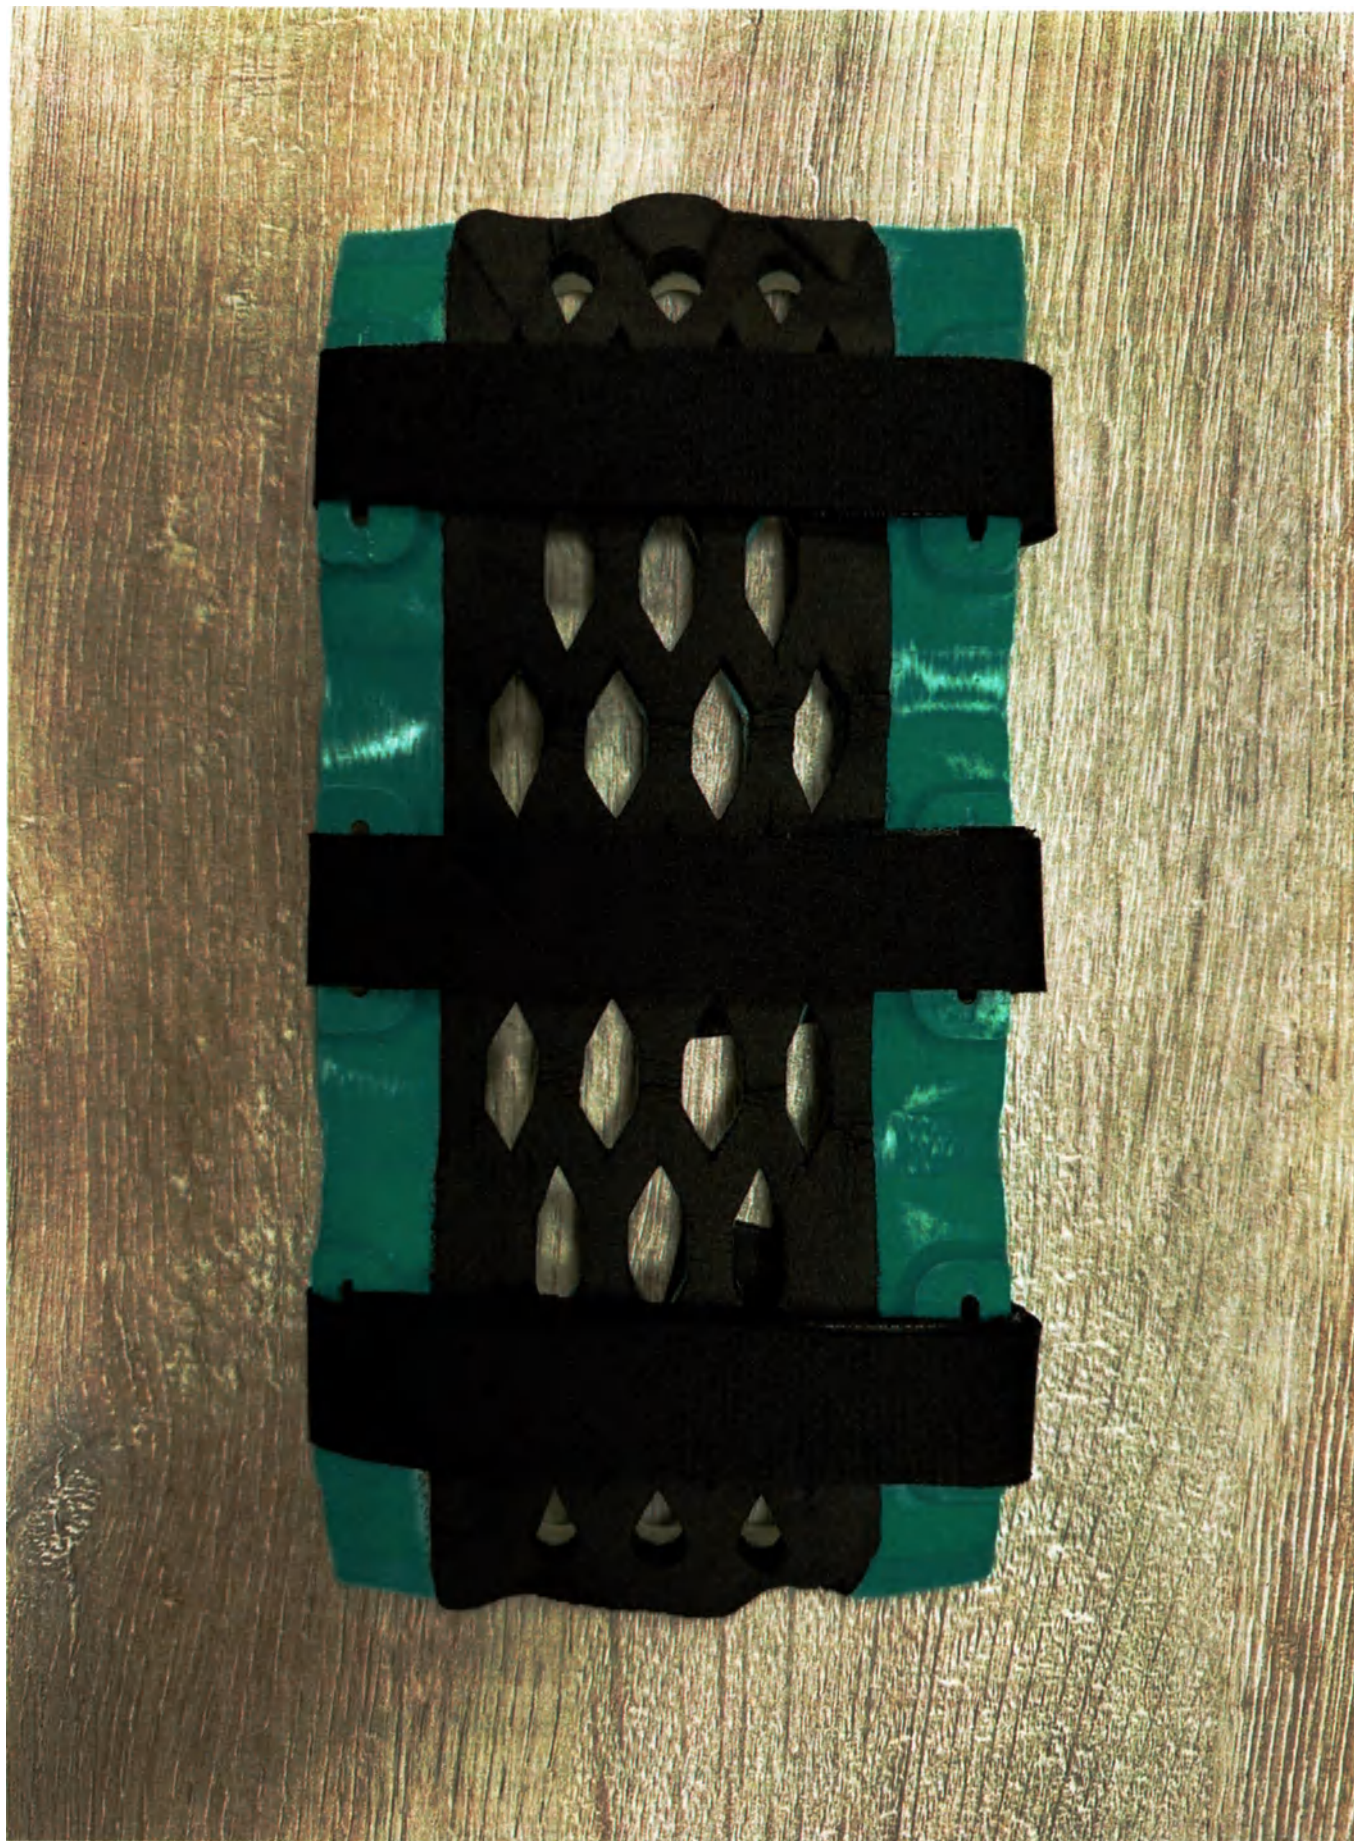


Рисунок 67. Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3х9 дюймов (Вид изнутри)

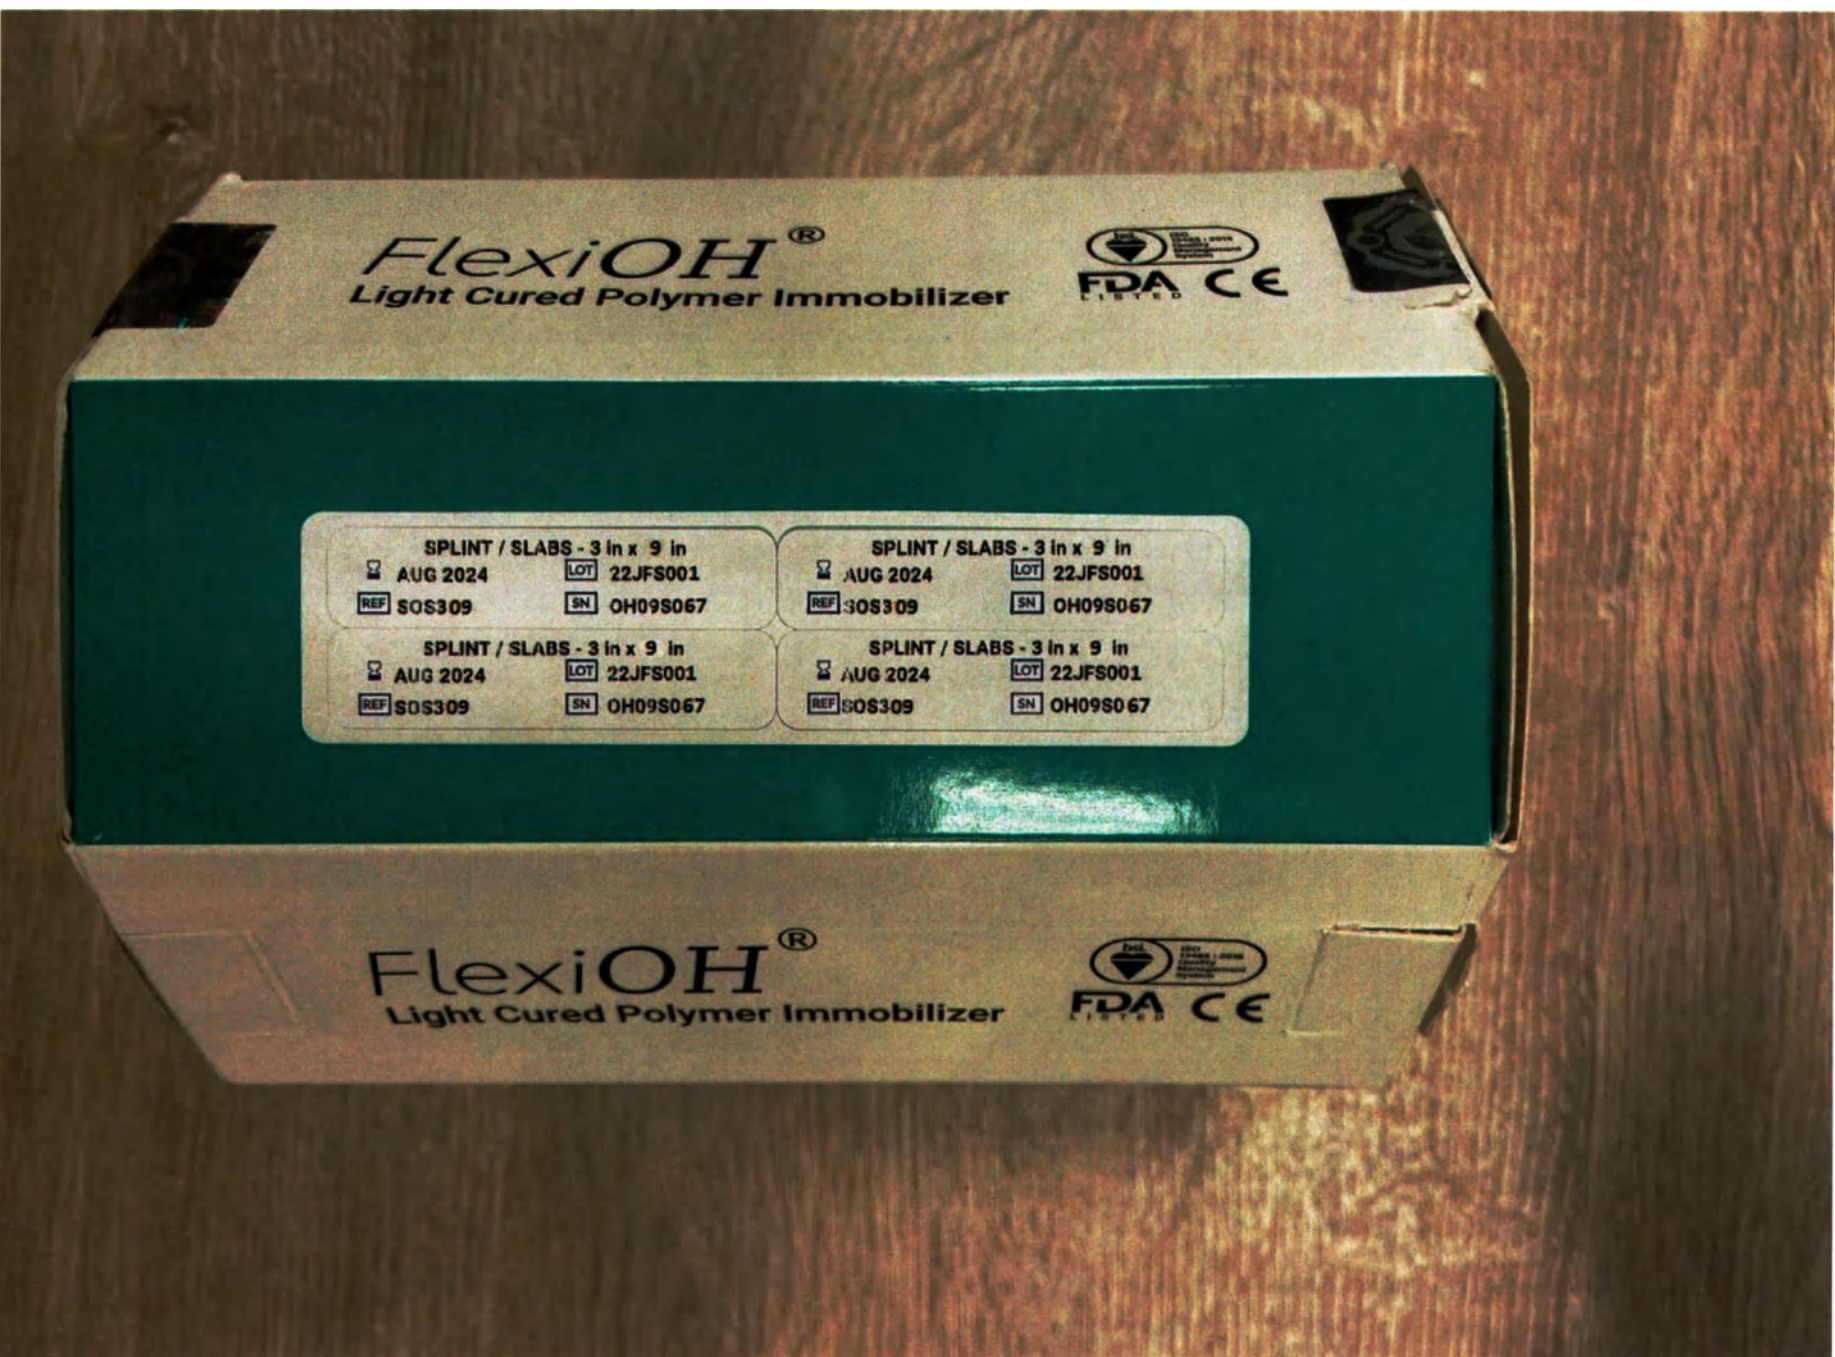


Рисунок 68. Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3x9 дюймов (Потребительская упаковка с маркировкой)





Рисунок 70. Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH® на примере размера 3x9 дюймов (Индивидуальная упаковка)

FlexiOH[®]

Light Cured Polymer Immobilizer



FDA LISTED



MADE IN INDIA



MD

Rx Only



DO NOT REUSE



NON STERILE



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED AND CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE



CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE



LATEX FREE



KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

WARNING: FlexiOH might feel hot or may cause discomfort on touching external surface while curing process. For more product information : www.orthoheal.com/instructions/



SEP 2022
AUG 2024
SOS309
22JFS001
OH09S067

22-SOS-1

SPLINT / SLABS - 3 in x 9 in

CONTENTS : (01) SPLINT / SLABS
(01) Instructions For Use
(01) Hook & Loop Fastener

SKU : OHFL-SOS-309-SS



UDI

(01)89080147651256
(17)082024
(21)22JFS001
(10)OH09S067



MANUFACTURER :

JC OrthoHeal Private Limited
GF-33/34, Classic Towers,
Near Akota Garden, Akota,
Vadodara - 390020. Gujarat, India.
www.orthoheal.com

For the complaint and feedback
Email: contact@orthoheal.com
Call: +91 85305 30885

EC REP

AF Pharma Service Europe SL
Muntaner 281, 5 1,
Barcelona, 08021, España

Рисунок 71 Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH[®] на примере размера 3х9 дюймов (Маркировка индивидуальной упаковки)



Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения:

Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiON®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 1.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 72 Инструкция по применению для варианта исполнения Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiON®

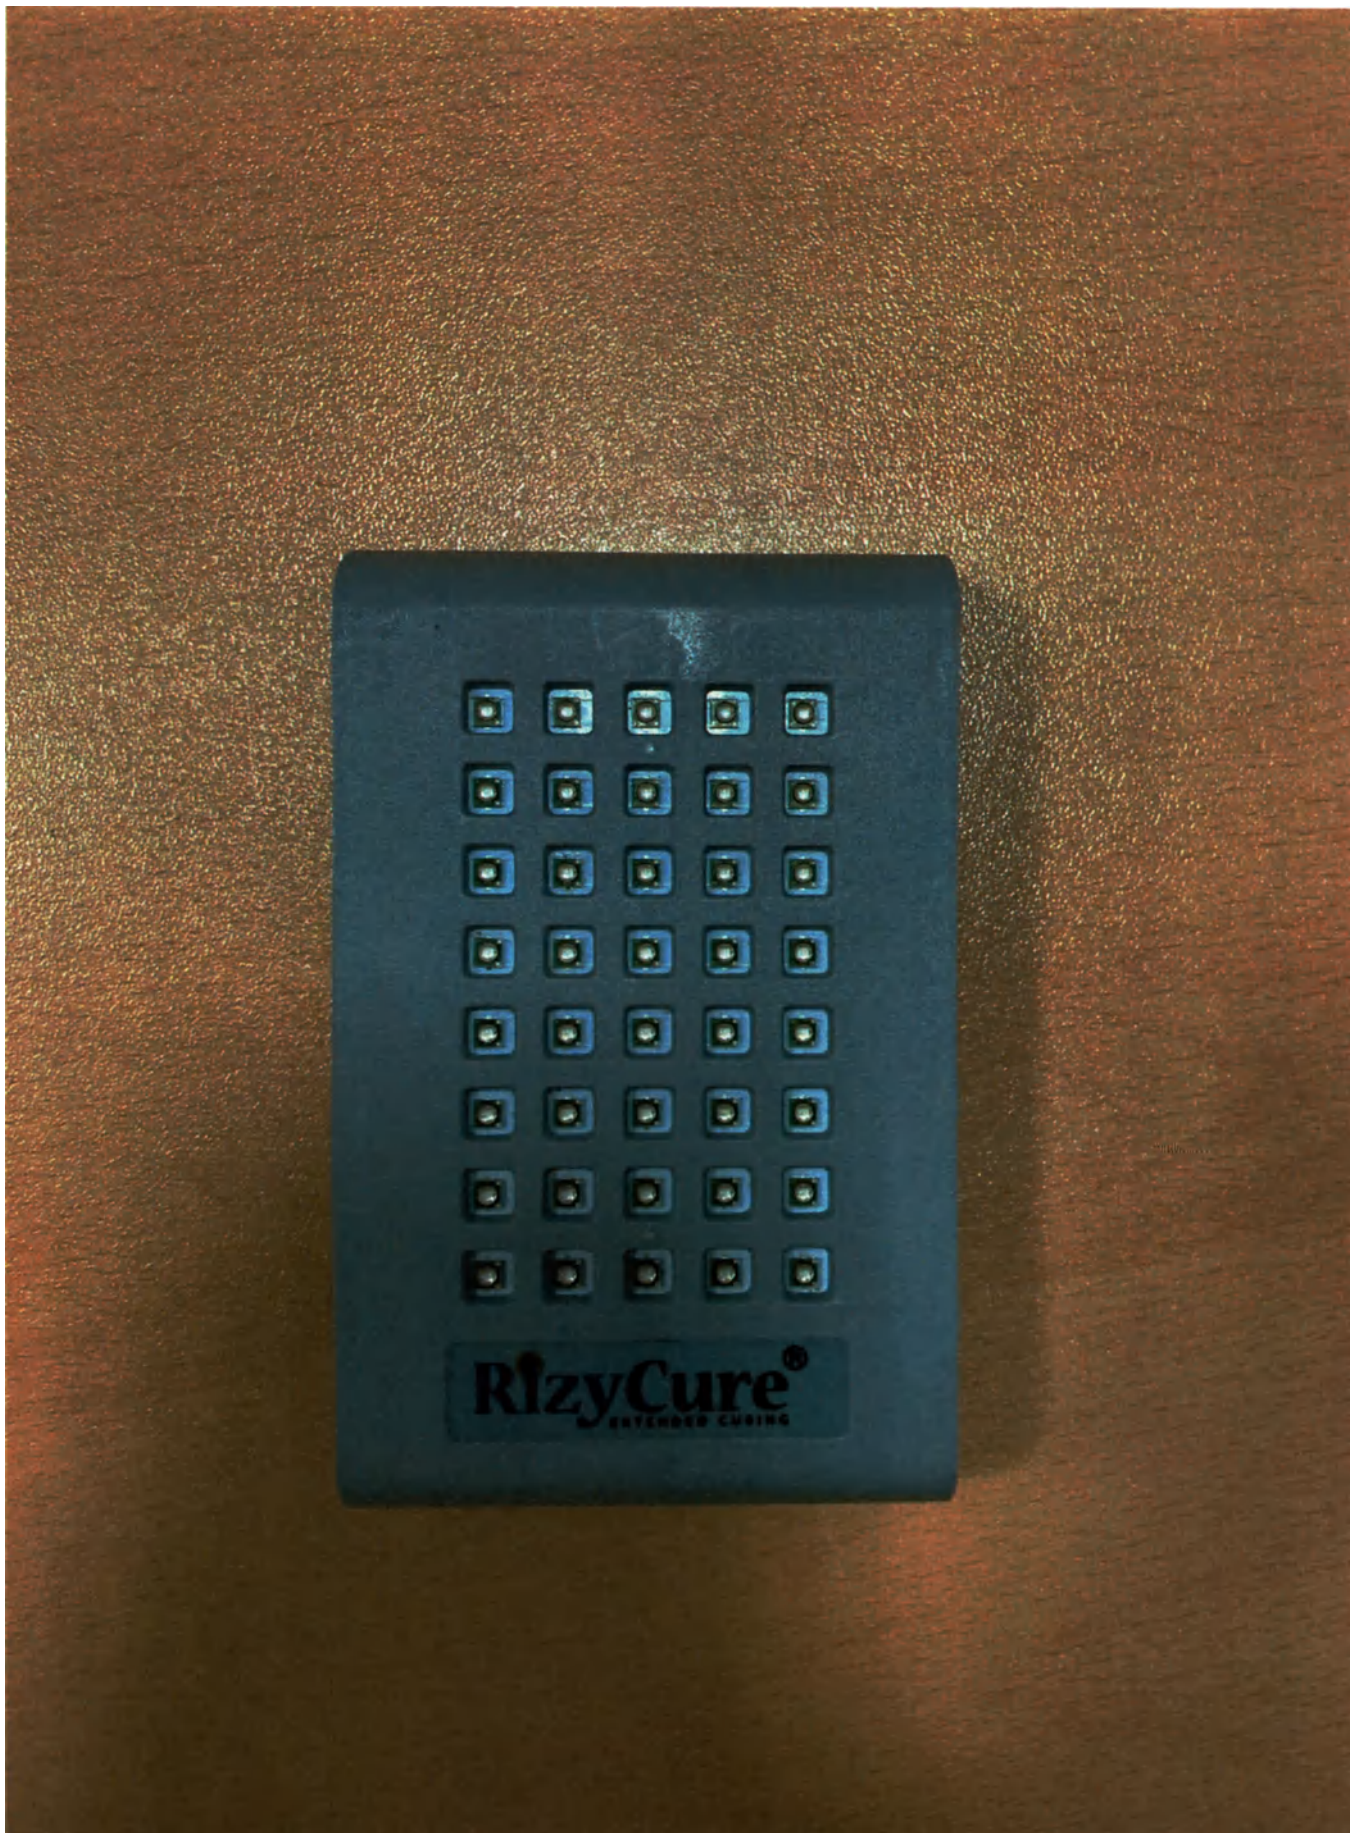


Рисунок 73. Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®(Вид спереди)



Рисунок 74. Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure® (Вид сзади)



Рисунок 75. Защитные очки (общий вид)



Рисунок 76. Кабель для заряда батареи (общий вид)

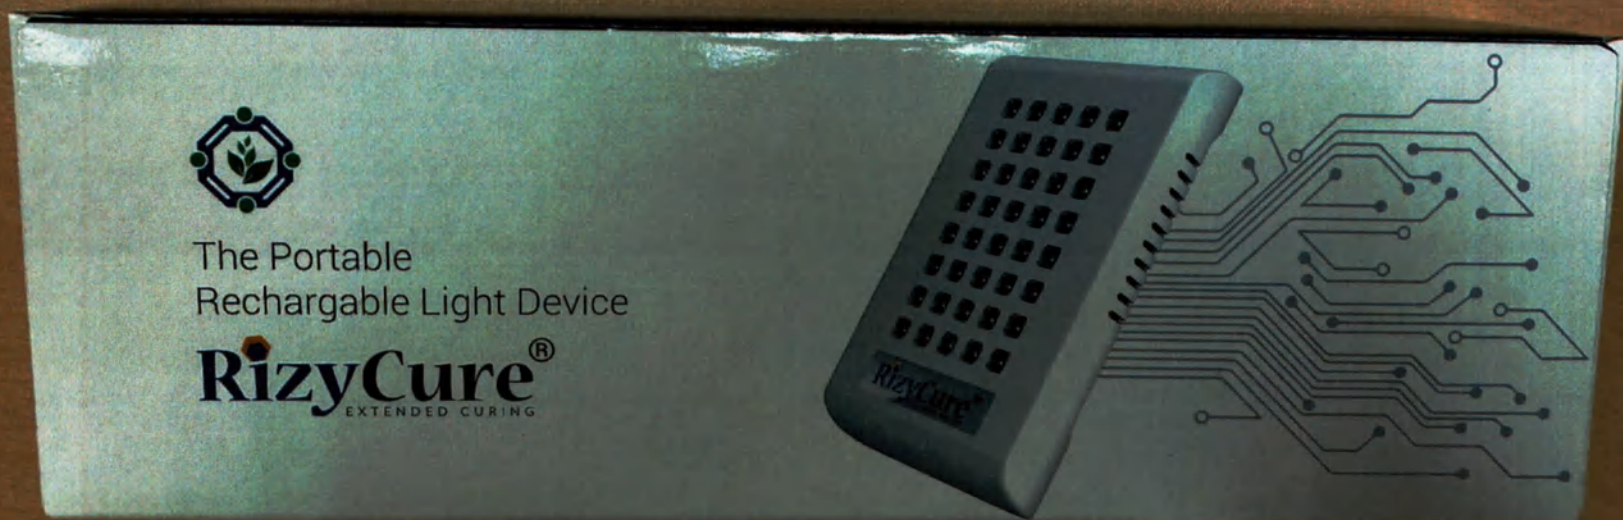




Рисунок 78 Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure® (Маркировка потребительской упаковки)



Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения

Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®

Руководство пользователя

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 2.0.
Дата последней редакции ноябрь 2022г.

Рисунок 79 Руководство пользователя для принадлежности Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®



Рисунок 80. Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe® на примере размера L (общий вид)

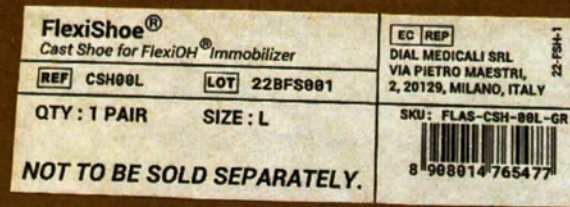


Рисунок 81. Накладка (чехол) на иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe® на примере размера L (Потребительская упаковка)



Рисунок 82. Устройство световое для полимеризации, проводное RzyCure® (Вид сверху)



Рисунок 83. Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure® (Вид снизу)



Рисунок 84. Кабель питания



Рисунок 85. Адаптер питания



Рисунок 86. Вилка для розетки типа С



Рисунок 87. Защитные очки



Рисунок 88 Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure® (Потребительская упаковка)



Рисунок 89 Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure® (Маркировка потребительской упаковки)



Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения

Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®

Руководство пользователя

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием продукта. Не удаляйте наклейки с продукта.

Версия 1.0.
Дата последней редакции февраль 2024 г.

Рисунок 90 Руководство пользователя для принадлежности Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®

***Макеты русскоязычной маркировки упаковки для медицинского изделия
«Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®», с принадлежностями, в вариантах
исполнения»***

РУ № РЗН 2023/19460 от _____

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH®, при необходимости, в размерах:
- Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) размер XS с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, г. Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

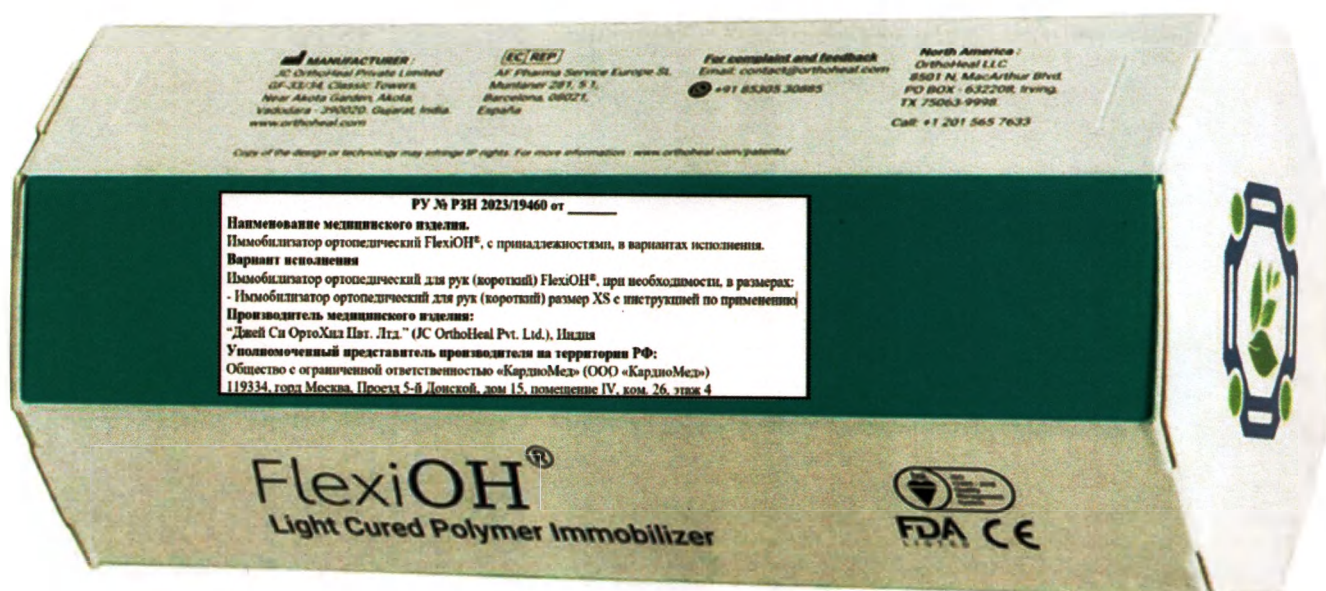


Рисунок 91 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для рук (короткий) FlexiOH® (на примере размера XS)

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) размер 2XS с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, г. Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

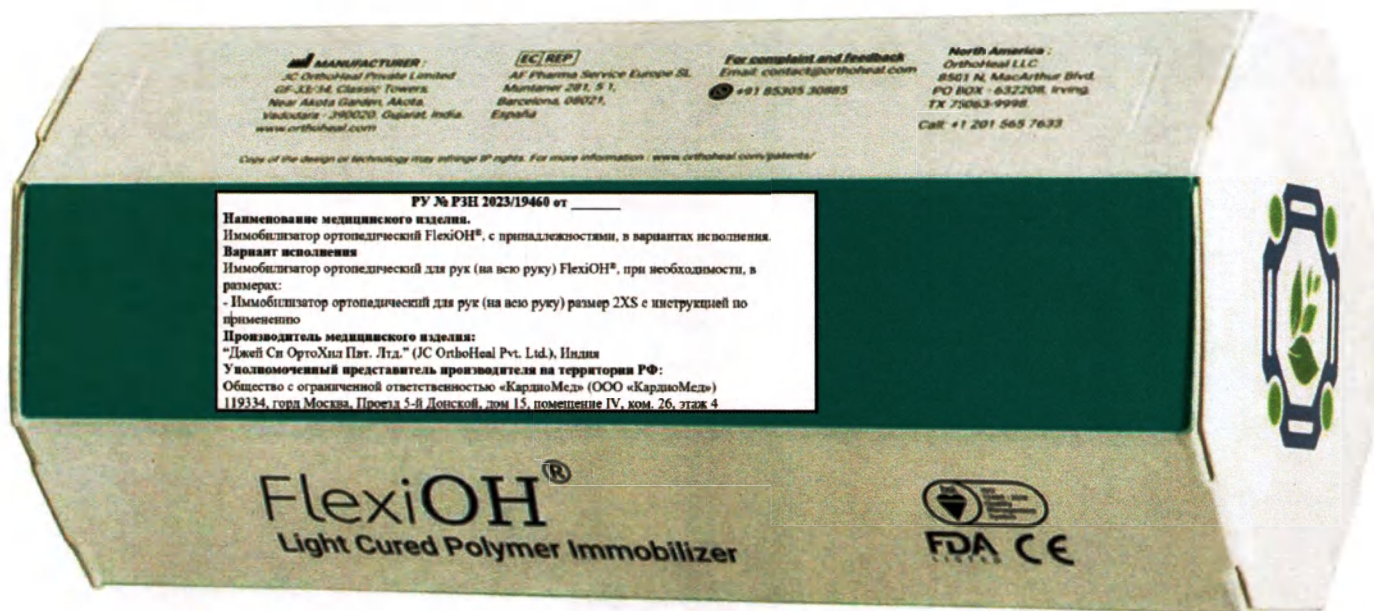


Рисунок 92 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для рук (на всю руку) FlexiOH® (на примере размера 2XS)

РУ № РЗН 2023/19460 от _____

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) размер 2XS с инструкцией по применению |

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

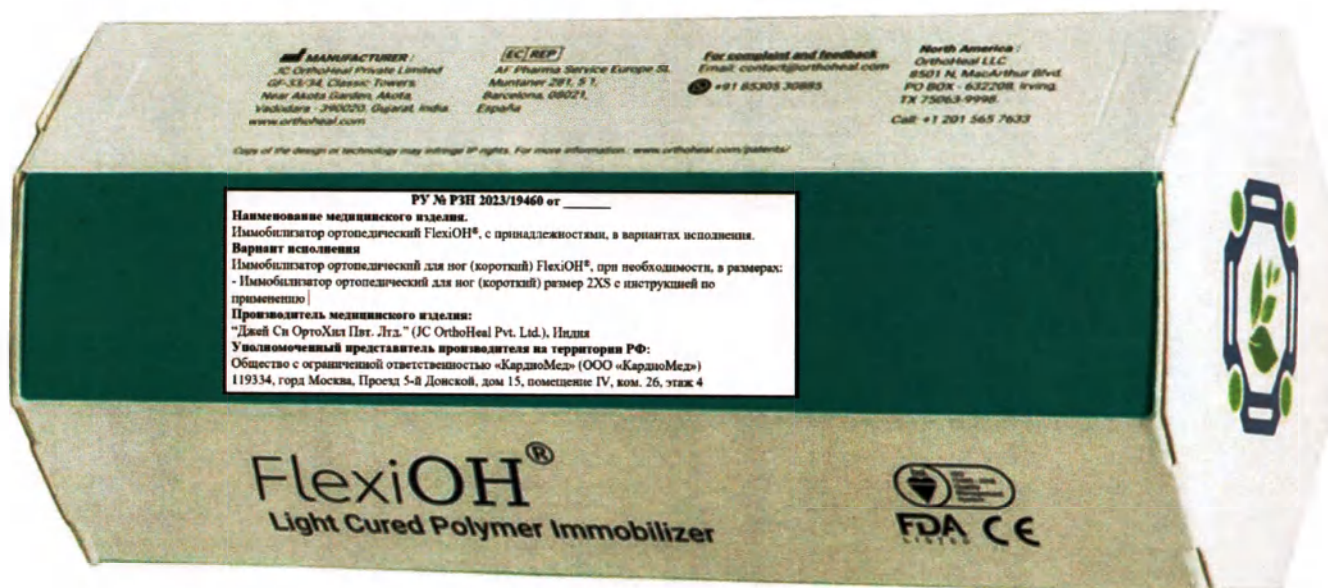


Рисунок 93 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для ног (короткий) FlexiOH® (на примере размера 2XS)

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки размер S с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

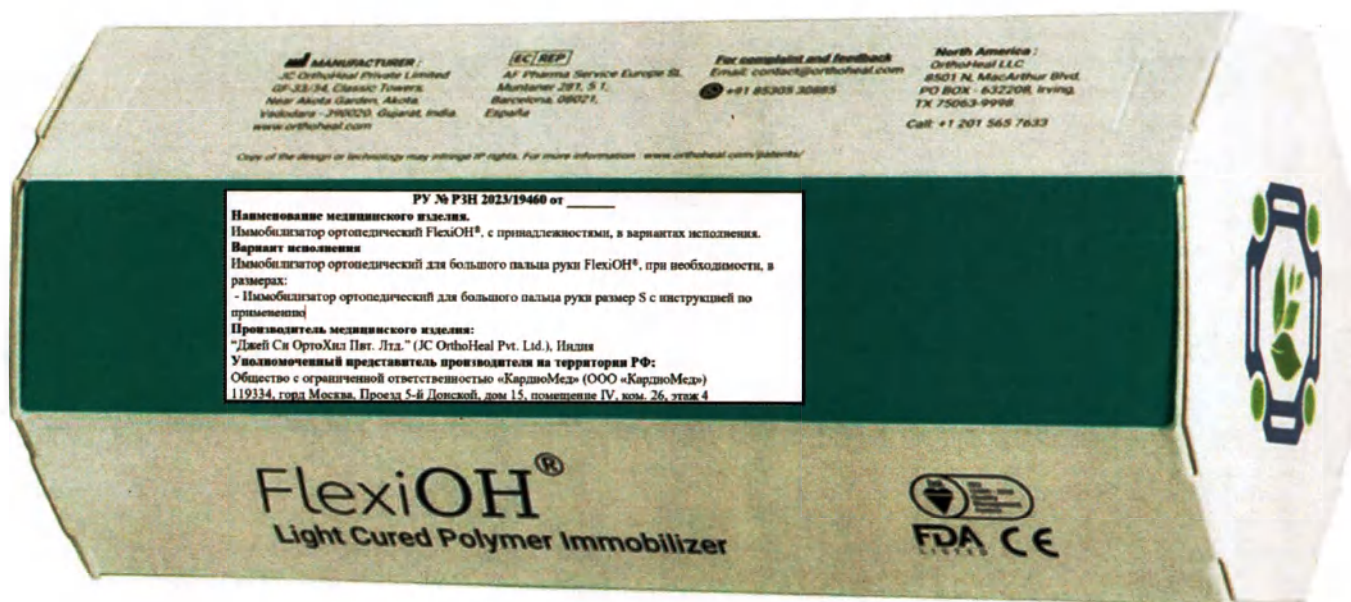


Рисунок 94 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки FlexiOH® (на примере размера S)

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки, (удлиненный) размер S с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

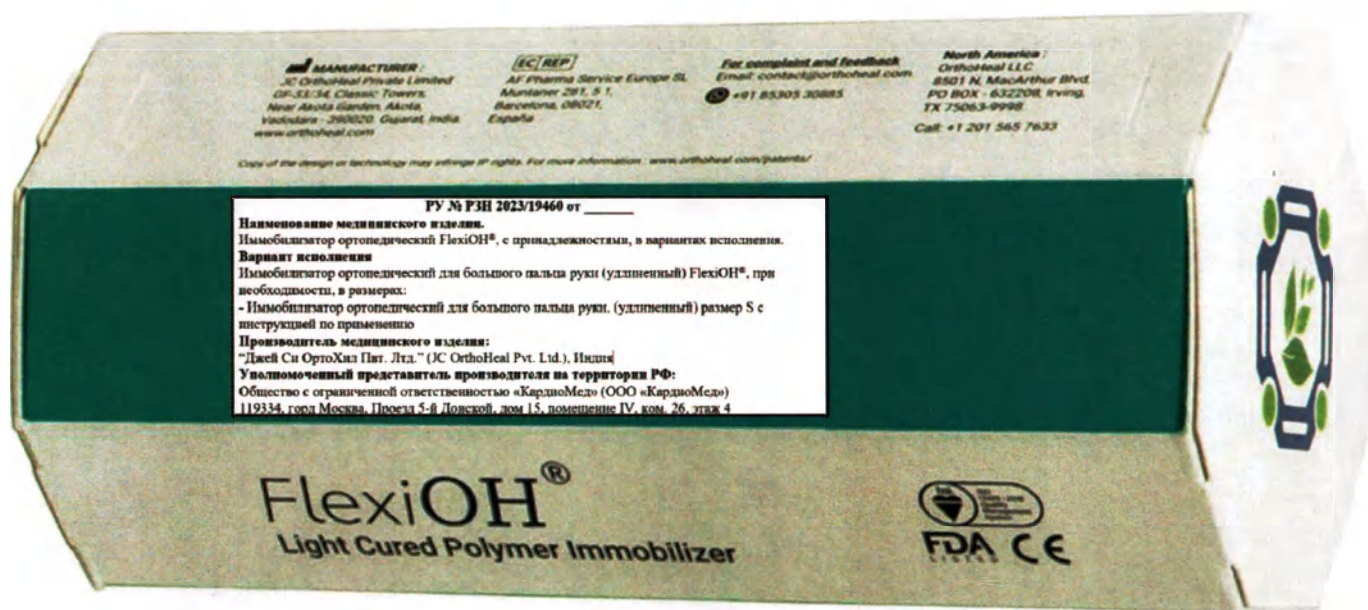


Рисунок 95 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для большого пальца руки (удлиненный) FlexiOH® (на примере размера S)

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки размер S с инструкцией по применению |

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

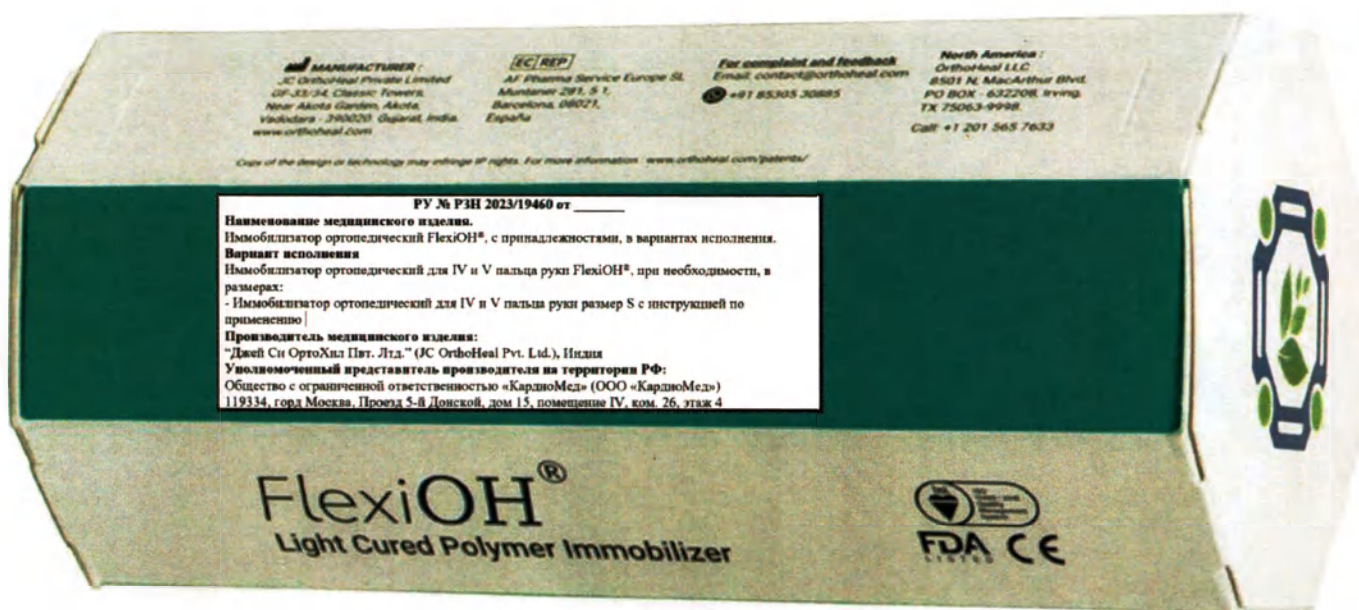


Рисунок 96 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для IV и V пальца руки FlexiOH® (на примере размера S)

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки размер S с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, г. Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

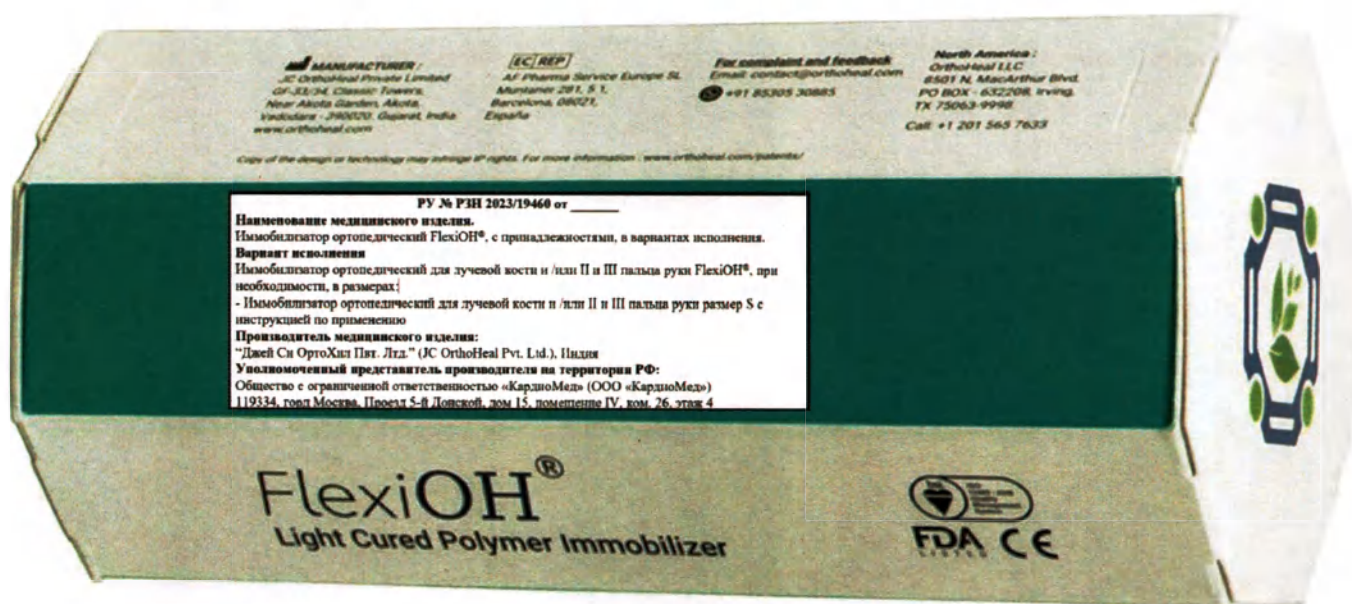


Рисунок 97 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Иммобилизатор ортопедический для лучевой кости и /или II и III пальца руки FlexiOH® (на примере размера S)

РУ № РЗН 2023/19460 от _____

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения

Шина-накладка ортопедическая для рук FlexiOH®, при необходимости, в размерах:

- Шина- накладка ортопедическая для рук, размер (3х9 дюймов) с инструкцией по применению

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

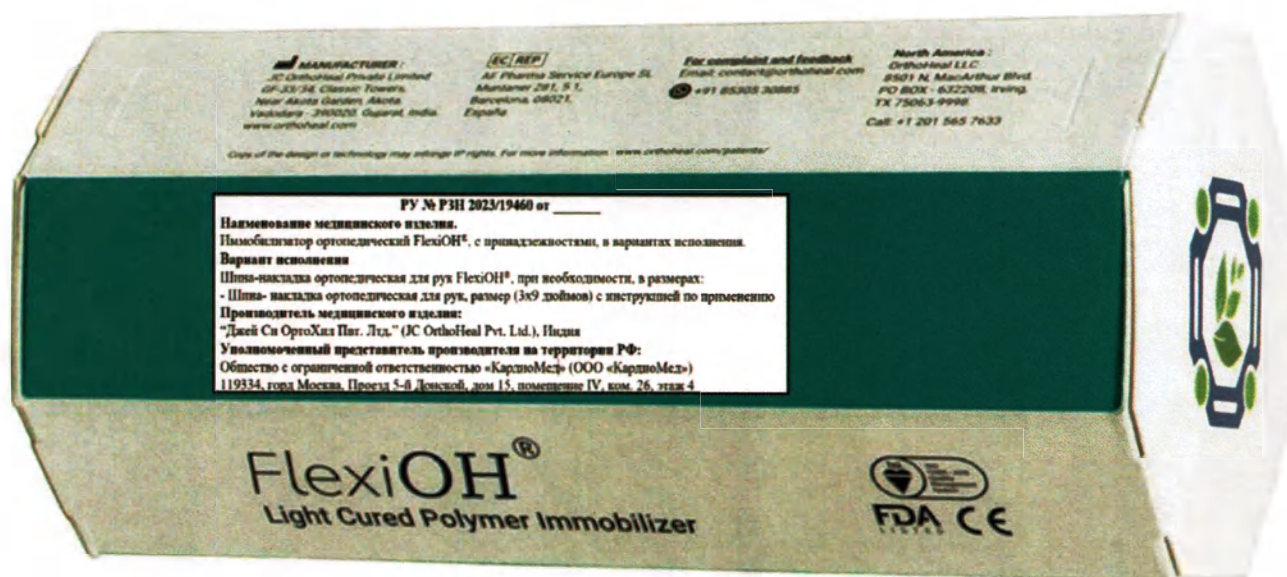


Рисунок 98 Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения Шина- накладка ортопедическая для рук FlexiOH®(на примере размера (3х9 дюймов))

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Принадлежности:

Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®, в составе:

- Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure® - 1 шт;
- Кабель для заряда батареи - 1 шт;
- Защитные очки - 3 шт;
- Руководство пользователя.

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

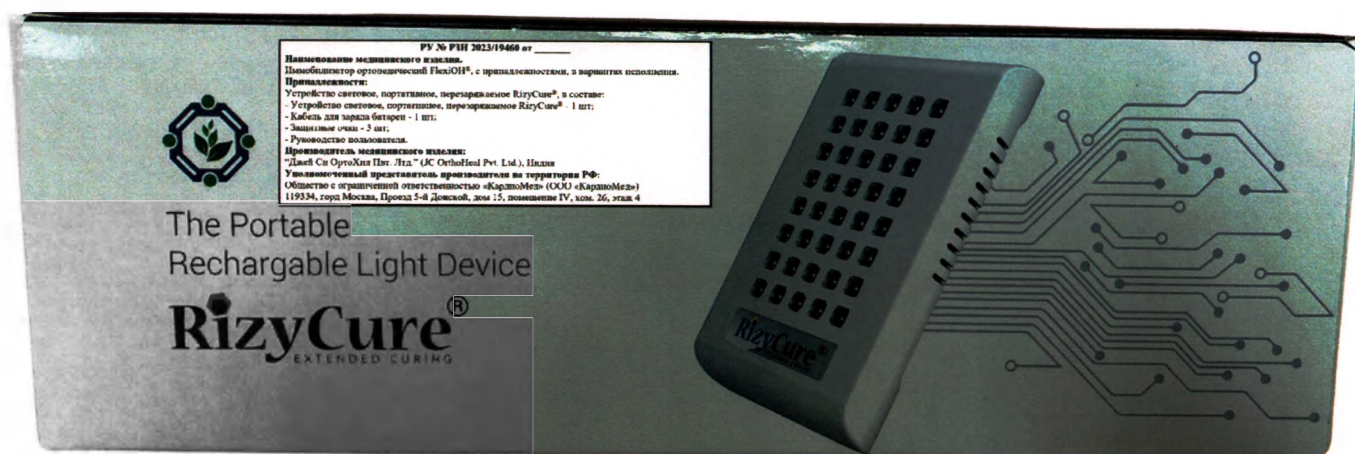


Рисунок 99 Макет русскоязычной маркировки для принадлежности Устройство световое, портативное, перезаряжаемое RizyCure®

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiON®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Принадлежности:

Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®, в составе:

- Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®- 1 шт;
- Кабель питания - 1 шт;
- Адаптер питания – 1 шт;
- Вилка для розетки типа С- 1 шт;
- Защитные очки - 3 шт;
- Руководство пользователя.

Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

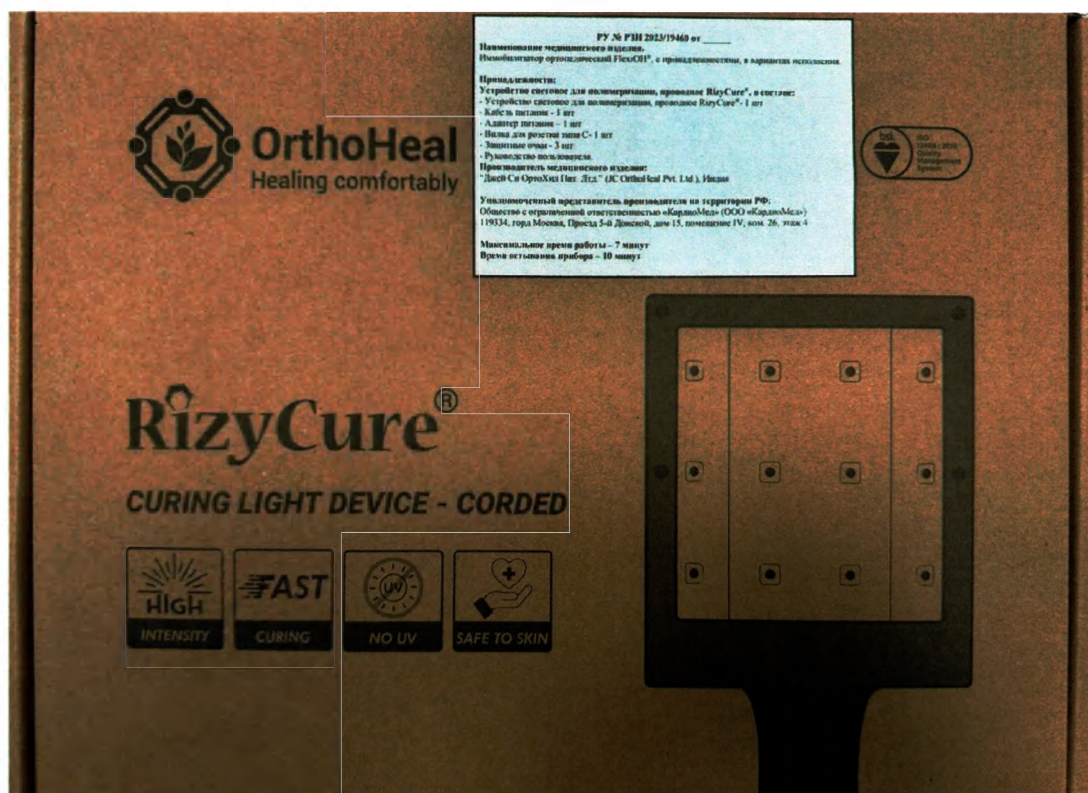


Рисунок 100 Макет русскоязычной маркировки для принадлежности Устройство световое для полимеризации, проводное RizyCure®

РУ № РЗН 2023/19460 от _____

Наименование медицинского изделия.

Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Принадлежности:

Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe®, в размерах:

- Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe®, размер L


Производитель медицинского изделия:

“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)

119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

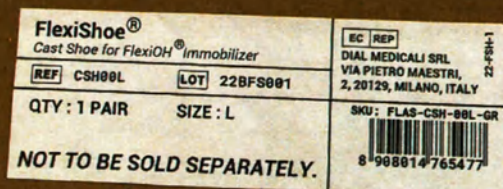

РУ № РЗН 2023/19460 от _____

Наименование медицинского изделия:
Иммобилизатор ортопедический FlexiOH®, с принадлежностями, в вариантах исполнения.

Принадлежности:
Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe®, в размерах:
- Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe®, размер L

Производитель медицинского изделия:
“Джей Си ОртоХил Пвт. Лтд.” (JC OrthoHeal Pvt. Ltd.), Индия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «КардиоМед» (ООО «КардиоМед»)
119334, город Москва, Проезд 5-й Донской, дом 15, помещение IV, ком. 26, этаж 4

Рисунок 101 Макет русскоязычной маркировки для принадлежности Накладка (чехол) на Иммобилизатор ортопедический для ног FlexiShoe® (на примере размера L)

ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
103 ЛИСТОВ

