

**Фотографические изображения и проект маркировки
медицинского изделия**

**«Наконечники стоматологические для микромоторов в составе с
принадлежностями в вариантах исполнения»**

**производство NAKANISHI INC. (НАКАНИШИ ИНК., Япония)
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan**

Наконечники стоматологические для микромоторов в составе с принадлежностями в вариантах исполнения

I. Наконечники стоматологические для микромоторов в составе, в вариантах исполнения:

1. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z в составе:

- 1.1. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z45L
- 1.2. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z-SG45L
- 1.3. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z-SG45
- 1.4. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z84L
- 1.5. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z85L
- 1.6. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z85
- 1.7. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z25L
- 1.8. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z24L
- 1.9. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z15L
- 1.10. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z: Z10L
- 1.11. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z в составе. Отвертка ключ для переключения режима охлаждения спреем, Wrench (по необходимости)
- 1.12. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z в составе. Насадка для смазки
- 1.13. Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z в составе. Инструкция.

2. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X в составе:

- 2.1. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: X95EX
- 2.2. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: X-SG65L
- 2.3. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: X-SG65
- 2.4. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: X-SG93L
- 2.5. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: X-SG93
- 2.6. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: Насадка для смазки.
- 2.7. Наконечники стоматологические серии Ti-Max X: Инструкция.

3. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano в составе:

- 3.1. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano95LS
- 3.2. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano25LS
- 3.3. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano15LS
- 3.4. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano65LS
- 3.5. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano SG20LS.
- 3.6. Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : Насадка для смазки.
- 3.7. Инструкция.

4. Наконечники стоматологические серии FX в составе:

- 4.1. Наконечники стоматологические серии FX: FX22
- 4.2. Наконечники стоматологические серии FX: FX25
- 4.3. Наконечники стоматологические серии FX: FX23
- 4.4. Наконечники стоматологические серии FX: FX65
- 4.5. Наконечники стоматологические серии FX: FX57
- 4.6. Наконечники стоматологические серии FX: FX15
- 4.7. Наконечники стоматологические серии FX: FX75.
- 4.8. Наконечники стоматологические серии FX: Ключ для кнопки.
- 4.9. Наконечники стоматологические серии FX: Насадка для смазки.
- 4.10. 4.1. Наконечники стоматологические серии FX: Инструкция.

5. Наконечники стоматологические серии SG в составе:


- 5.1. Наконечники стоматологические серии SG: SGR2-E
- 5.2. Наконечники стоматологические серии SG: SGO2-E
- 5.3. Наконечники стоматологические серии SG: SGT2-E
- 5.4. Наконечники стоматологические серии SG: SGA-ES
- 5.5. Наконечники стоматологические серии SG: SGA-E2S
- 5.6. Наконечники стоматологические серии SG: SGS-ES
- 5.7. Наконечники стоматологические серии SG: SGS-E2S.
- 5.8. Наконечники стоматологические серии SG: Ключ для извлечения микропилы
- 5.9. Наконечники стоматологические серии SG: Насадка для смазки.
- 5.10. Наконечники стоматологические серии SG: Инструкция.

II. Принадлежности к наконечникам стоматологическим для микромоторов:

Принадлежности к наконечникам стоматологическим для микромоторов Картридж к наконечникам.

Принадлежности к наконечникам стоматологическим для микромоторов Кнопка к наконечникам.

Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z45L

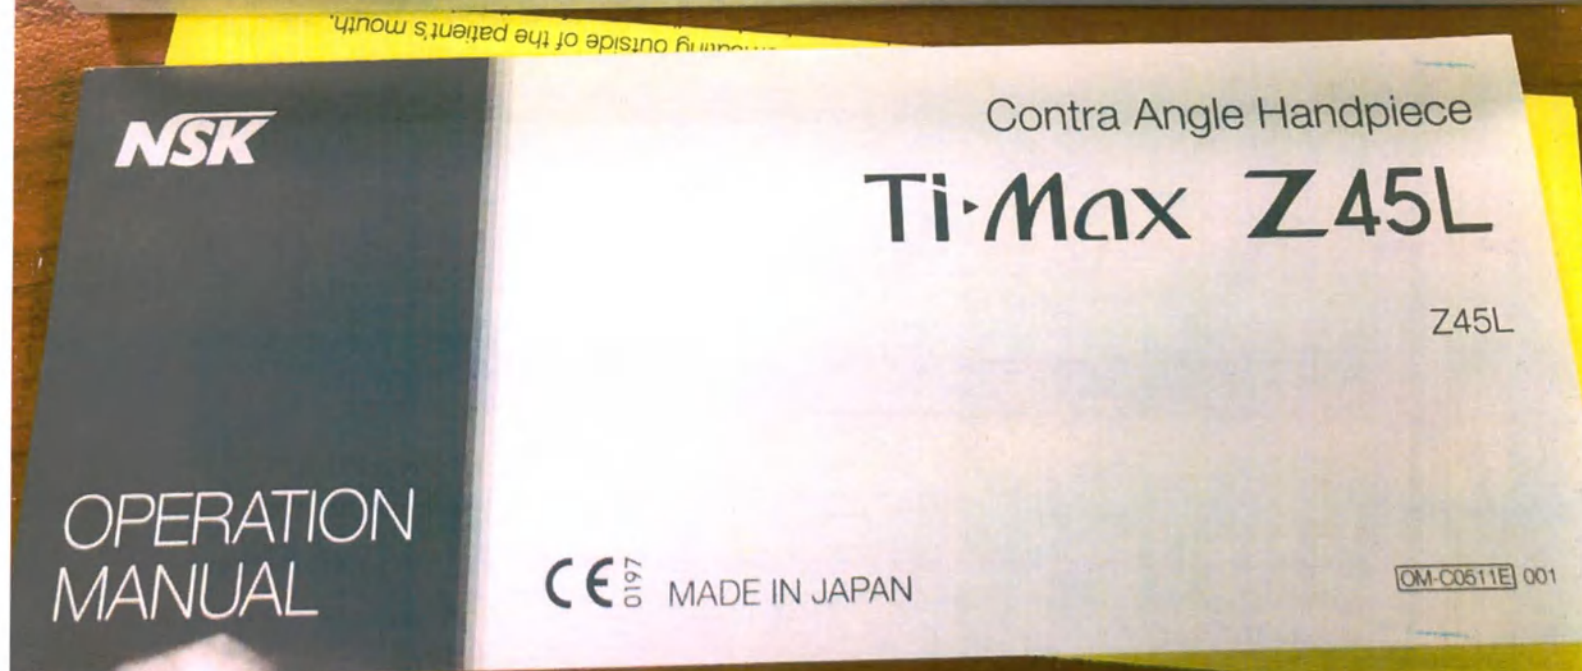

NSK



NSK

OPERATION MANUAL

Please read this OPERATION MANUAL
carefully before use, and file for future
reference.

Surgical Contra Angle Handpiece

Ti-Max Z

Z-SG45L
Z-SG45

CE 0197 MADE IN JAPAN

CM-C0537E 001

Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z-SG45



NSK


OPERATION MANUAL

Please read this OPERATION MANUAL
carefully before use, and file for future
reference.

Surgical Contra Angle Handpiece

Ti-Max Z

Z-SG45L
Z-SG45



MADE IN JAPAN

CM-C0537E 001

Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z84L



Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z85L



Contra Angle Handpiece

Ti-Max Z

Z10L / Z10 / Z15L / Z15 / Z24L / Z25L / Z25
Z84L / Z85L / Z85 / Z95L / Z95

NSK

OPERATION MANUAL

Please read this OPERATION MANUAL
carefully before use, and file for future
reference.

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-C0442E 003

Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z85



Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z25L



Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z24L



Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z15L



Наконечники стоматологические серии Ti-Max Z : Z10L



NSK

OPERATION MANUAL

Please read this OPERATION MANUAL
carefully before use, and file for future
reference.

Contra Angle Handpiece

Ti-Max Z


Z10L / Z10 / Z15L / Z15 / Z24L / Z25L / Z25
Z84L / Z85L / Z85 / Z95L / Z95

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-C0442E


Наконечники стоматологические серии Ti-Max X : X95EX

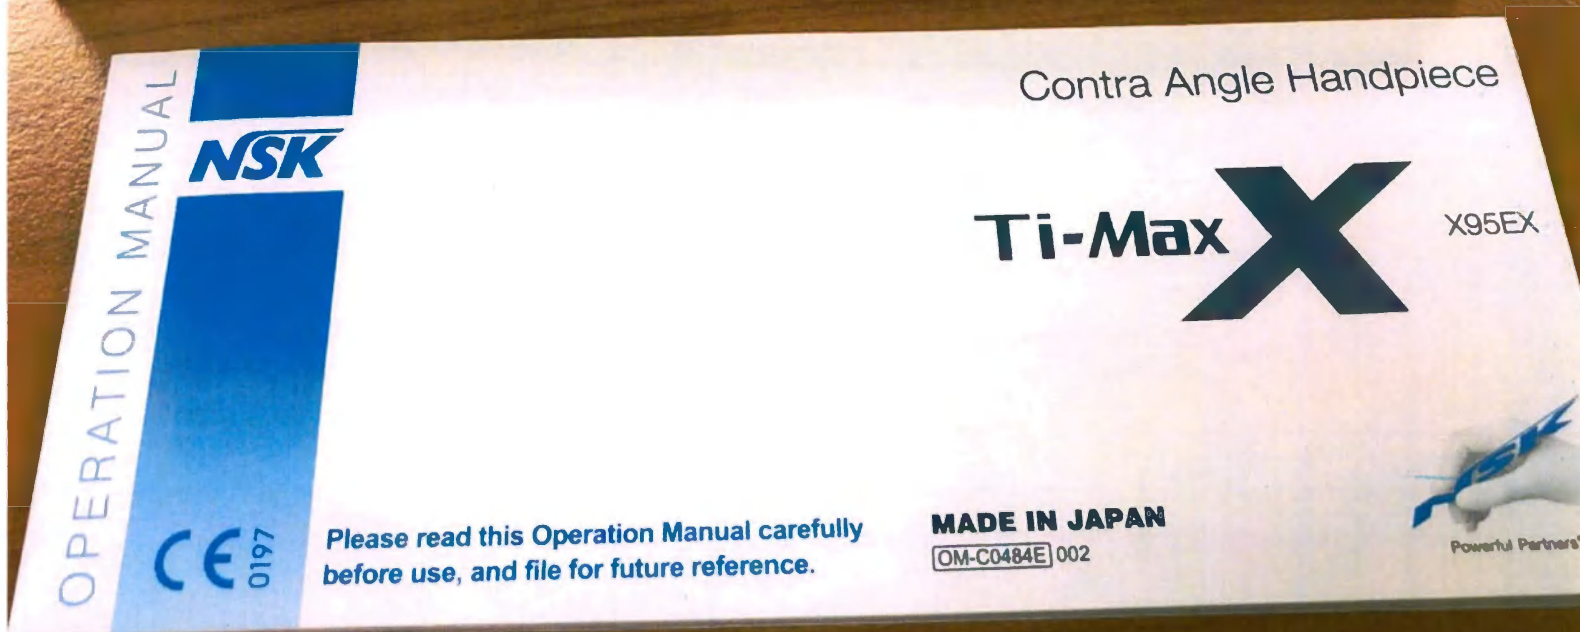

Наконечники стоматологические серии Ti-Max X : X-SG65L




Наконечники стоматологические серии Ti-Max X : X-SG65

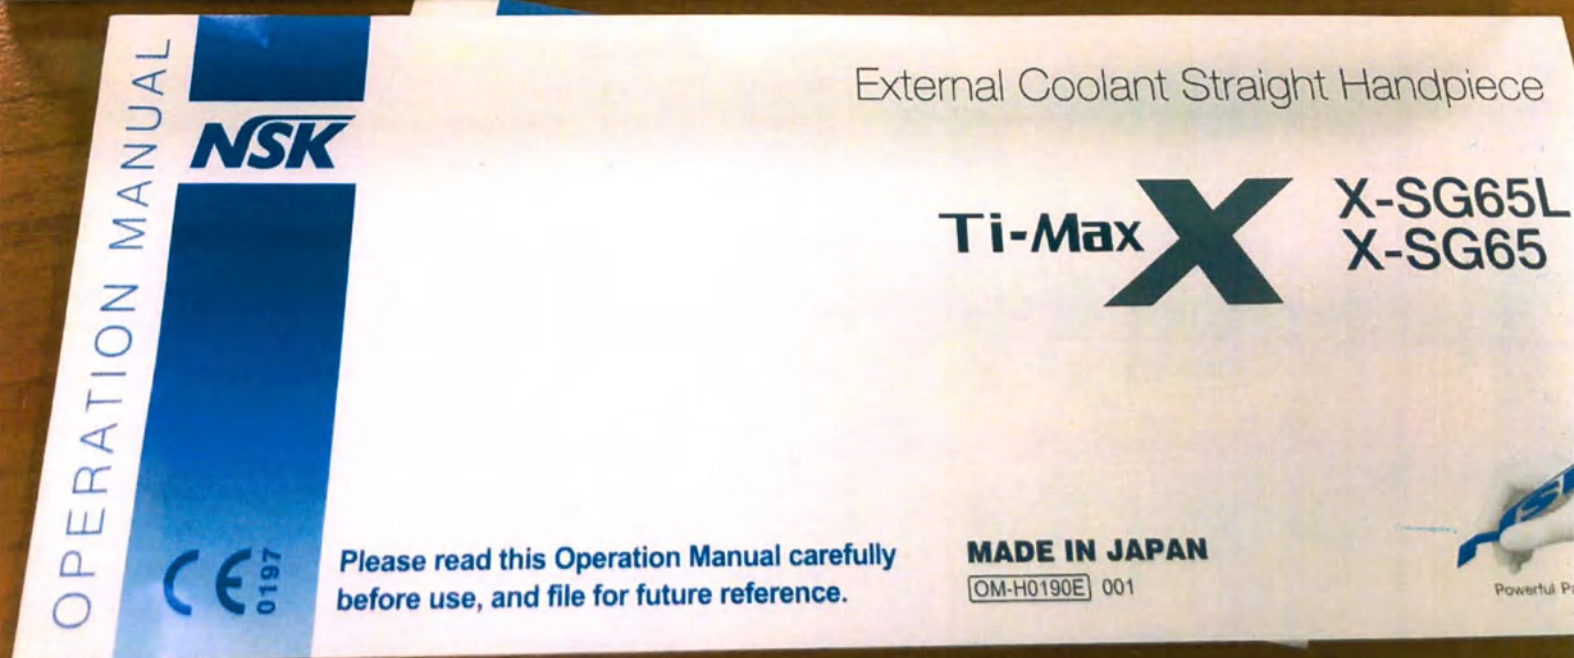

Наконечники стоматологические серии Ti-Max : X-SG93L



Наконечники стоматологические серии Ti-Max X : X-SG93

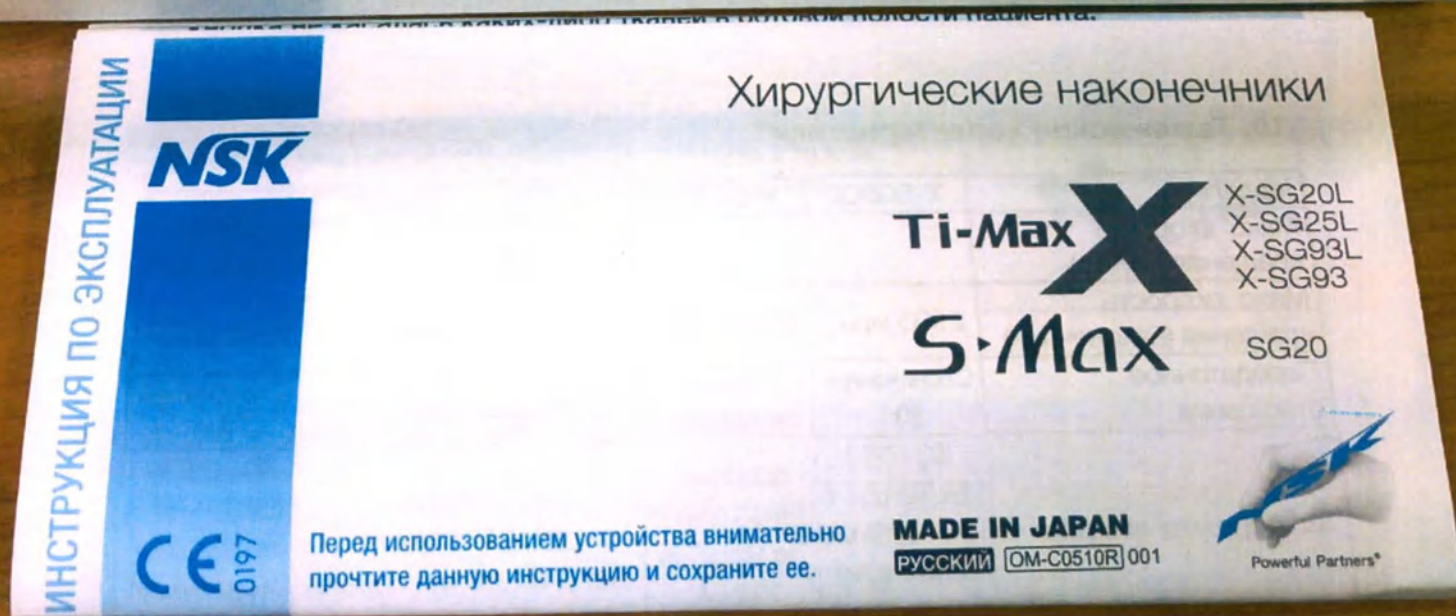

Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano95LS



NSK

FINEST PRECISION ROTARY



NSK

Contra Angle Handpiece

Ti-Max nano

nano15LS
nano25LS
nano95LS

OPERATION
MANUAL

CE 0197 MADE IN JAPAN

OM-C0520E

NSK

FINEST PRECISION ROTATION



NSK

OPERATION MANUAL

Please read this OPERATION MANUAL
carefully before use, and file for future
reference.

Contra Angle Handpiece

Ti-Max nano

nano15LS
nano25LS
nano95LS

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-00620E 001

Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano1! 5



Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nano65LS



Наконечники стоматологические серии Ti-Max nano : nanoSG20LS



Наконечники стоматологические серии FX : FX22



NSK

**OPERATION
MANUAL**

Contra Angle Handpiece

FX15 / FX15m

FX23 / FX23m

FX25 / FX25m

FX75 / FX75m

FX15 / FX15m / FX23 / FX23m

FX25 / FX25m / FX75 / FX75m

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-C

Наконечники стоматологические серии FX : FX25



NSK

Contra Angle Handpiece

FX15 / FX15m

FX23 / FX23m

FX25 / FX25m

FX75 / FX75m

FX15 / FX15m / FX23 / FX23m

FX25 / FX25m / FX75 / FX75m

CE 0197 **MADE IN JAPAN**

OM-C0438E

OPERATION
MANUAL

Наконечники стоматологические серии FX : FX23



NSK

Contra Angle Handpiece

FX15 / FX15m

FX23 / FX23m

FX25 / FX25m

FX75 / FX75m

FX15 / FX15m / FX23 / FX23m

FX25 / FX25m / FX75 / FX75m


OPERATION
MANUAL

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-C0438E 001

Наконечники стоматологические серии FX : FX65

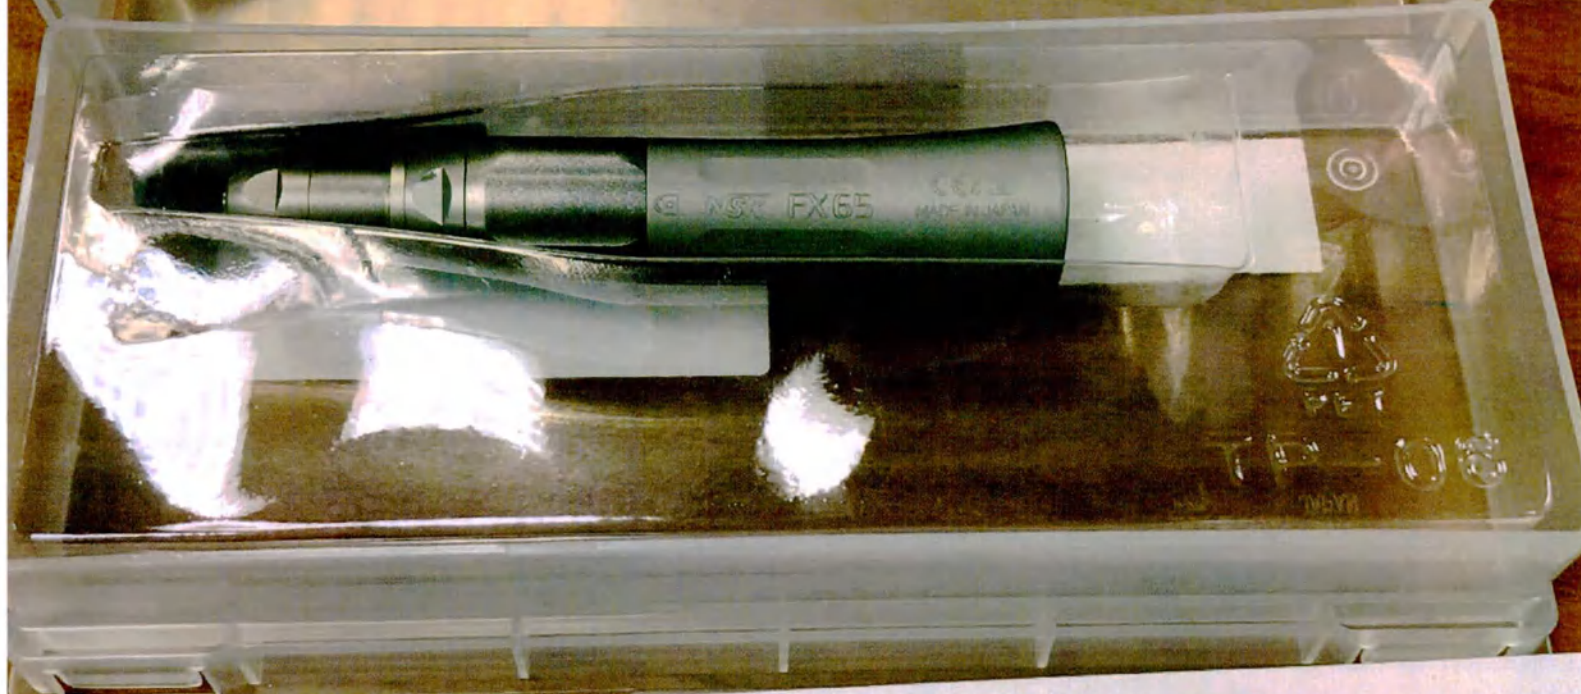

Наконечники стоматологические серии FX : FX57



Наконечники стоматологические серии FX : FX15



NSK

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

Contra ângulo Baixa Velocidade

FX15 / FX15m

FX23 / FX23m

FX25 / FX25m

FX75 / FX75m

FX15 / FX15m / FX23 / FX23m
FX25 / FX25m / FX75 / FX75m

CE 0197

MADE IN JAPAN

PORTUGUÊS

OM-C0513P

Наконечники стоматологические серии FX : FX75



NSK

Contra Angle Handpiece

FX15 / FX15m

FX23 / FX23m

FX25 / FX25m

FX75 / FX75m

FX15 / FX15m / FX23 / FX23m

FX25 / FX25m / FX75 / FX75m

OPERATION
MANUAL

CE 0197

MADE IN JAPAN

OM-C0438E

Наконечники стоматологические серии SG : SGR2-E



BONE SURGERY MICRO SAW HANDPIECE

SGR2-E/SGO2-E/SGT2-E

OPERATION MANUAL

NSK


CE 0197

Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference

MADE IN JAPAN

OM-H0187E 001



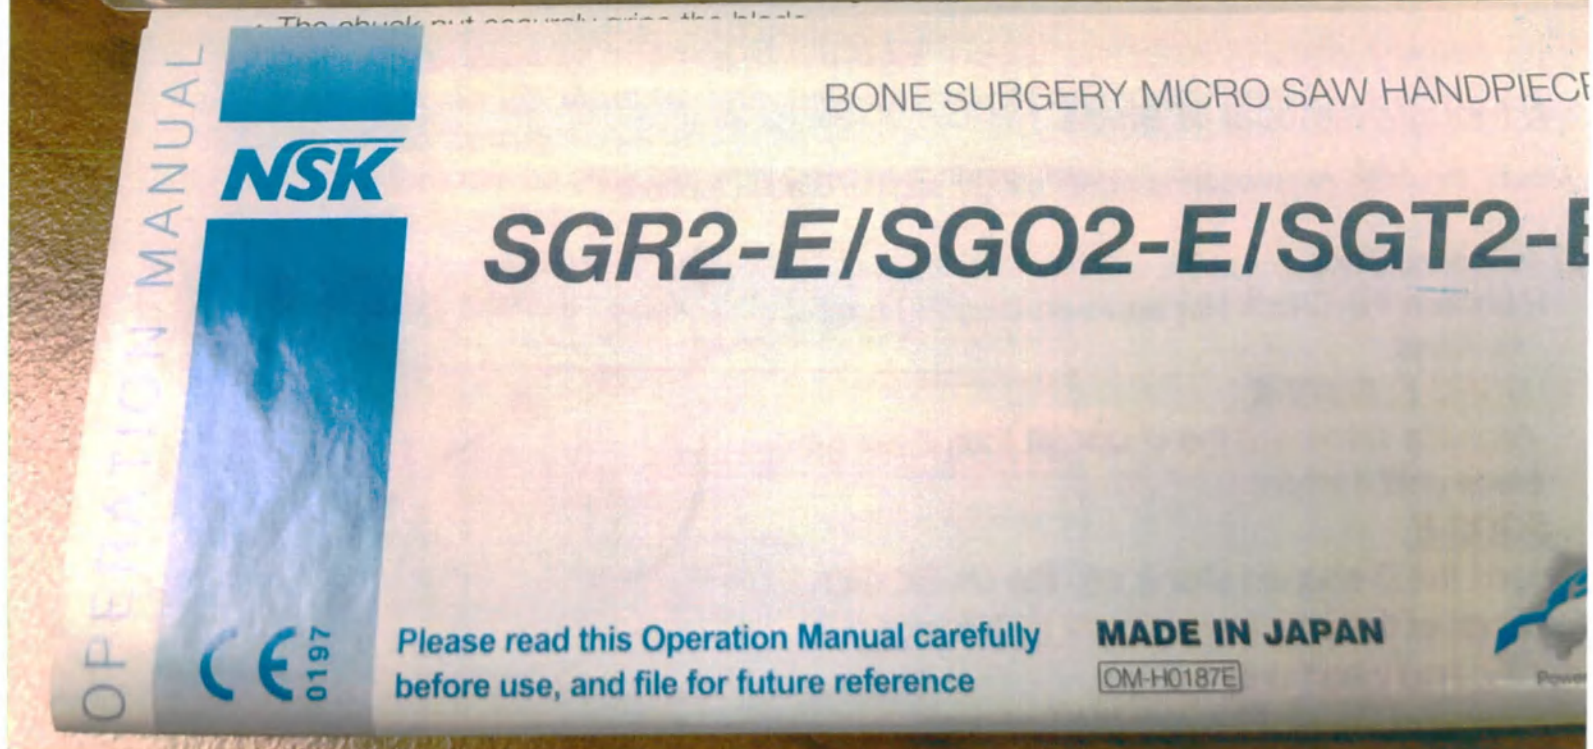

Наконечники стоматологические серии SG : SGT2-E



BONE SURGERY MICRO SAW HANDPIECE

SGR2-E/SGO2-E/SGT2-E

CE 0197

Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference

MADE IN JAPAN
OM-H0187E 001



Наконечники стоматологические серии SG : SGA-ES



OPERATION MANUAL

NSK

CE 0197

Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference

Surgical Handpiece

SGS / SGA

MADE IN JAPAN

OM-SH0015E 004



Powerful Partner

Наконечники стоматологические серии SG : SGA-E2S



Surgical Handpiece

SGS / SGA

SGS-ES / SGS-EM / SGS-EL
SGS-E2S / SGS-E2M / SGS-E2L
SGA-ES / SGA-EM / SGA-EL
SGA-E2S / SGA-E2M / SGA-E2L

Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference

MADE IN JAPAN
OM-SH0015E 005



OPERATION MANUAL

NSK

Наконечники стоматологические серии SG : SGS-ES



Surgical Handpiece

SGS / SGA

SGS-ES / SGS-EM / SGS-EL
SGS-E2S / SGS-E2M / SGS-E2L
SGA-ES / SGA-EM / SGA-EL
SGA-E2S / SGA-E2M / SGA-E2L



Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference


MADE IN JAPAN

OM-SH0015E 005



Powerful Partners®

Наконечники стоматологические серии SG : SGS-E2S

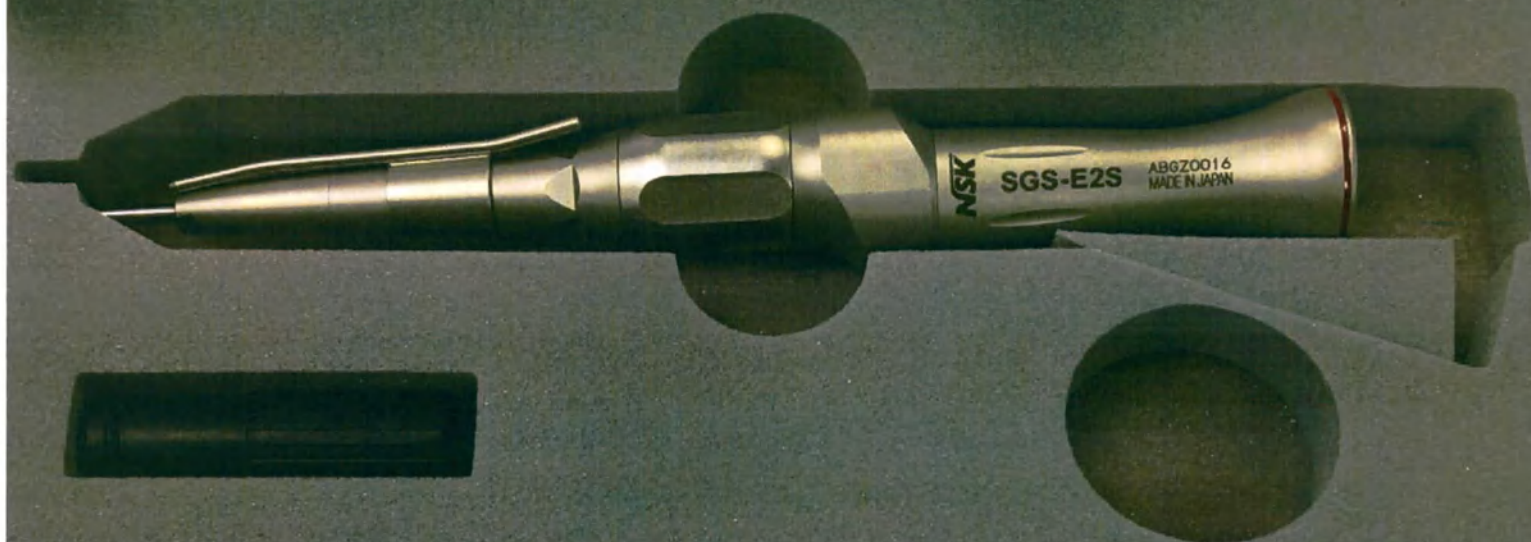

Surgical Handpiece

SGS / SGA

SGS-ES / SGS-EM / SGS-EL
SGS-E2S / SGS-E2M / SGS-E2L
SGA-ES / SGA-EM / SGA-EL
SGA-E2S / SGA-E2M / SGA-E2L

Please read this Operation Manual carefully
before use, and file for future reference

MADE IN JAPAN



OM-SH0015E 005





Powerful Partners®





Картридж к наконечникам серий Ti-Max Z

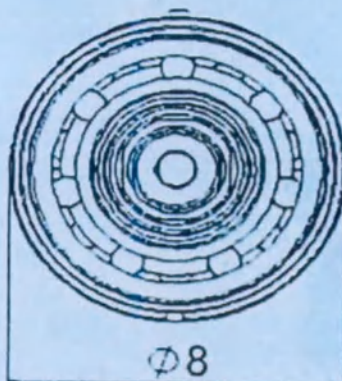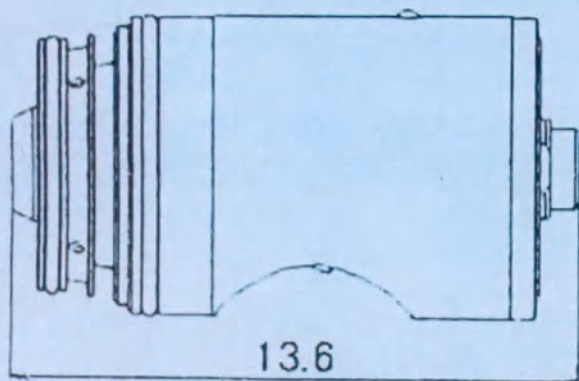


Картридж к наконечникам серий Ti-Max X

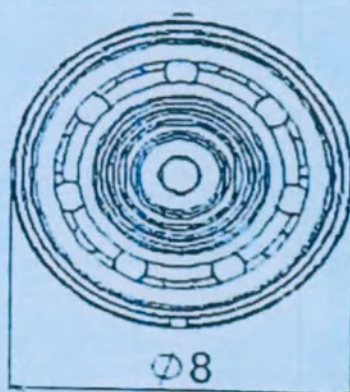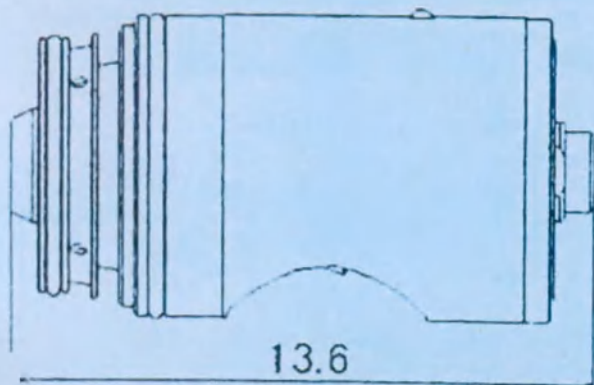

Картридж к наконечникам серий **Ti-Max nano**

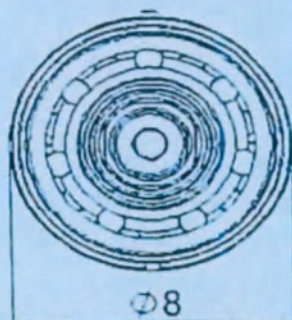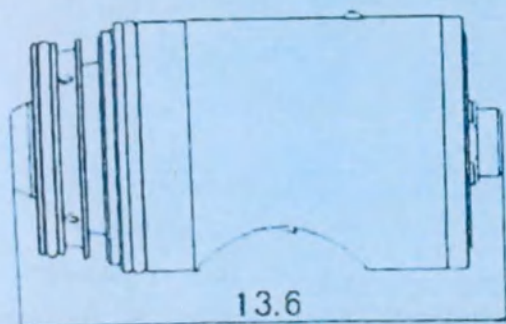


Картридж к наконечникам серии **FX**

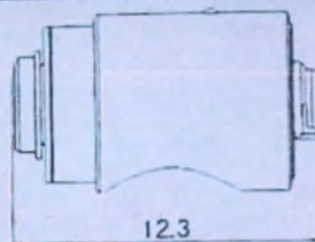

Кнопка к наконечникам серий Ti-Max Z



4.2




9.6


Кнопка к наконечникам серий **Ti-Max X**



Юбка к наконечникам серии Ti-Max nano



Кнопка к наконечникам серии FX



Упаковка и маркировка

Упаковка

	Внешняя коробка
Размер, мм	150 x 70 x 30

Маркировка производителя



Маркировка транспортной упаковки



Макет маркировки для Российской Федерации

Наконечники стоматологические для микромоторов в составе с принадлежностями в вариантах исполнения:

(РУ № _____ от _____ года)

REF

SN

Режим хранения и транспортировки:

Температура: от -10 до 50 °С (окружающая среда)

Относительная влажность:

от 10 до 85 % (без конденсации)

Давление: от 500 до 1060 гПа



NAKANISHI INC. (НАКАНИШИ ИНК.)

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

Телефон: +81 289 64 3380; Факс: +81 289 62 5636

MAIL : info@nsk-nakanishi.co.jp

Уполномоченный представитель производителя: ООО «НСК РУС»

109544, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Таганский, 6-й Энтузиастов, д. 2, этаж 11

офис 17; Тел. +7 (495) 967 9607; MAIL : info@nsk-nakanishi.ru



Макет транспортной маркировки для Российской Федерации

Наконечники стоматологические для микромоторов в составе с принадлежностями в вариантах исполнения:

(РУ № _____ от _____ года)

REF

SN

Режим хранения и транспортировки:

Температура: от -10 до 50 °C(окружающая среда)

Относительная влажность:

от 10 до 85 % (без конденсации)

Давление: от 500 до 1060 гПа



**NAKANISHI INC. (НАКАНИШИ ИНК.) 700 Shimobinata, Kanuma, Tochigi 322-8666,
Japan** Телефон: +81 289 64 3380; Факс: +81 289 62 5636 MAIL : info@nsk-nakanishi.co.jp

Уполномоченный представитель производителя: ООО «НСК РУС» 109544, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 11 офис 17; Тел. +7 (495) 967 9607; MAIL
: info@nsk-nakanishi.ru

Вручить и
из 50 тысяч
судебных
дел канцелярии
приставов
Белого
Землянского
района
и
Землянского
района
и
Землянского
района

