



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


**Калибратор консолидированный для обеспечения правильности
количественного определения аналитов клинической химии**

в биологических жидкостях человека


на биохимических анализаторах Alinity c

**«Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c
(Consolidated Chemistry Calibrator)»**


Фотографическое изображение общего вида МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), вид снаружи

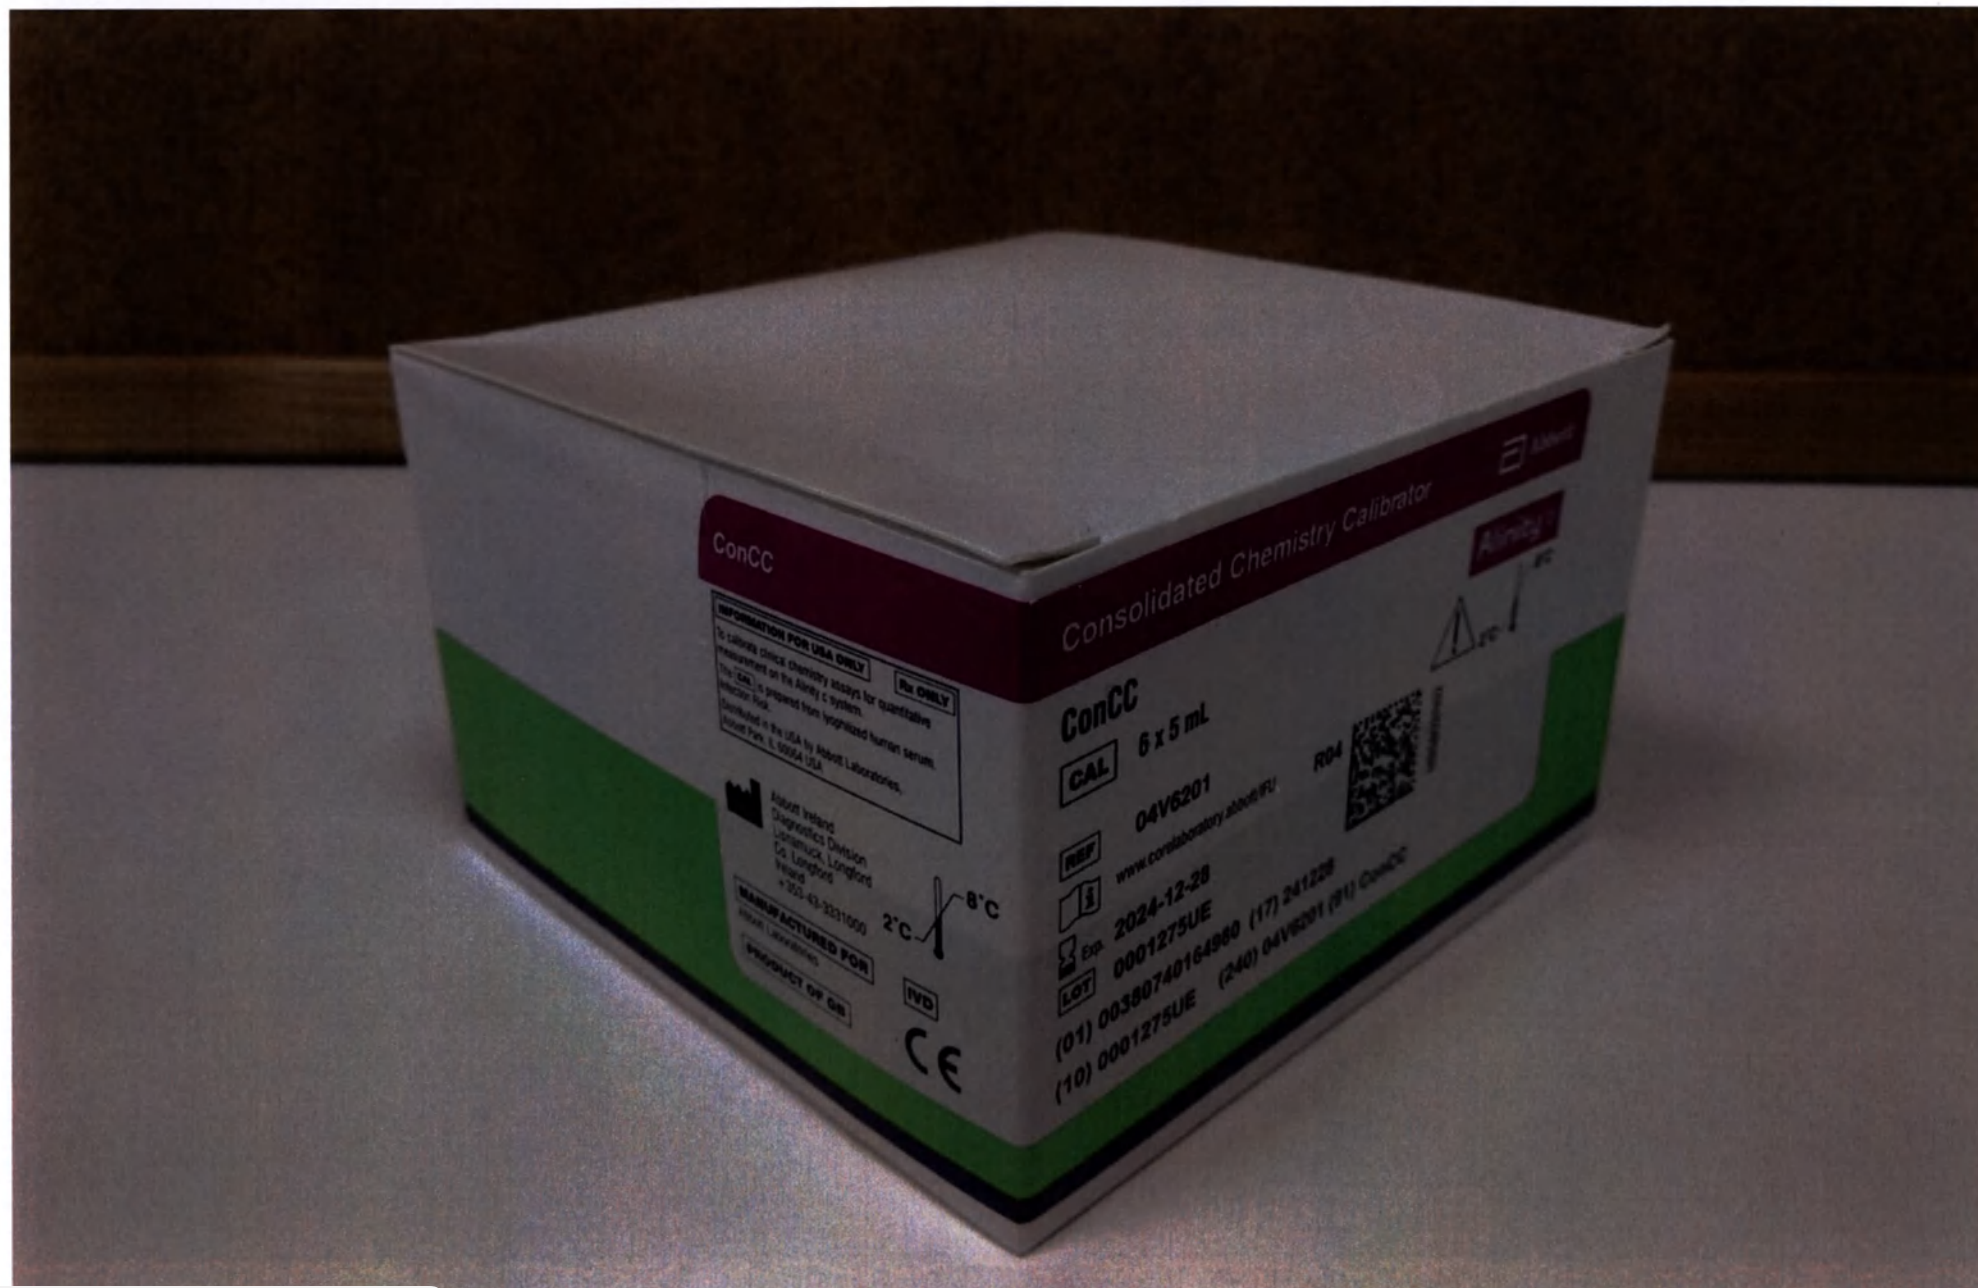


Фотографическое изображение общего вида МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c
(Consolidated Chemistry Calibrator), вид снаружи

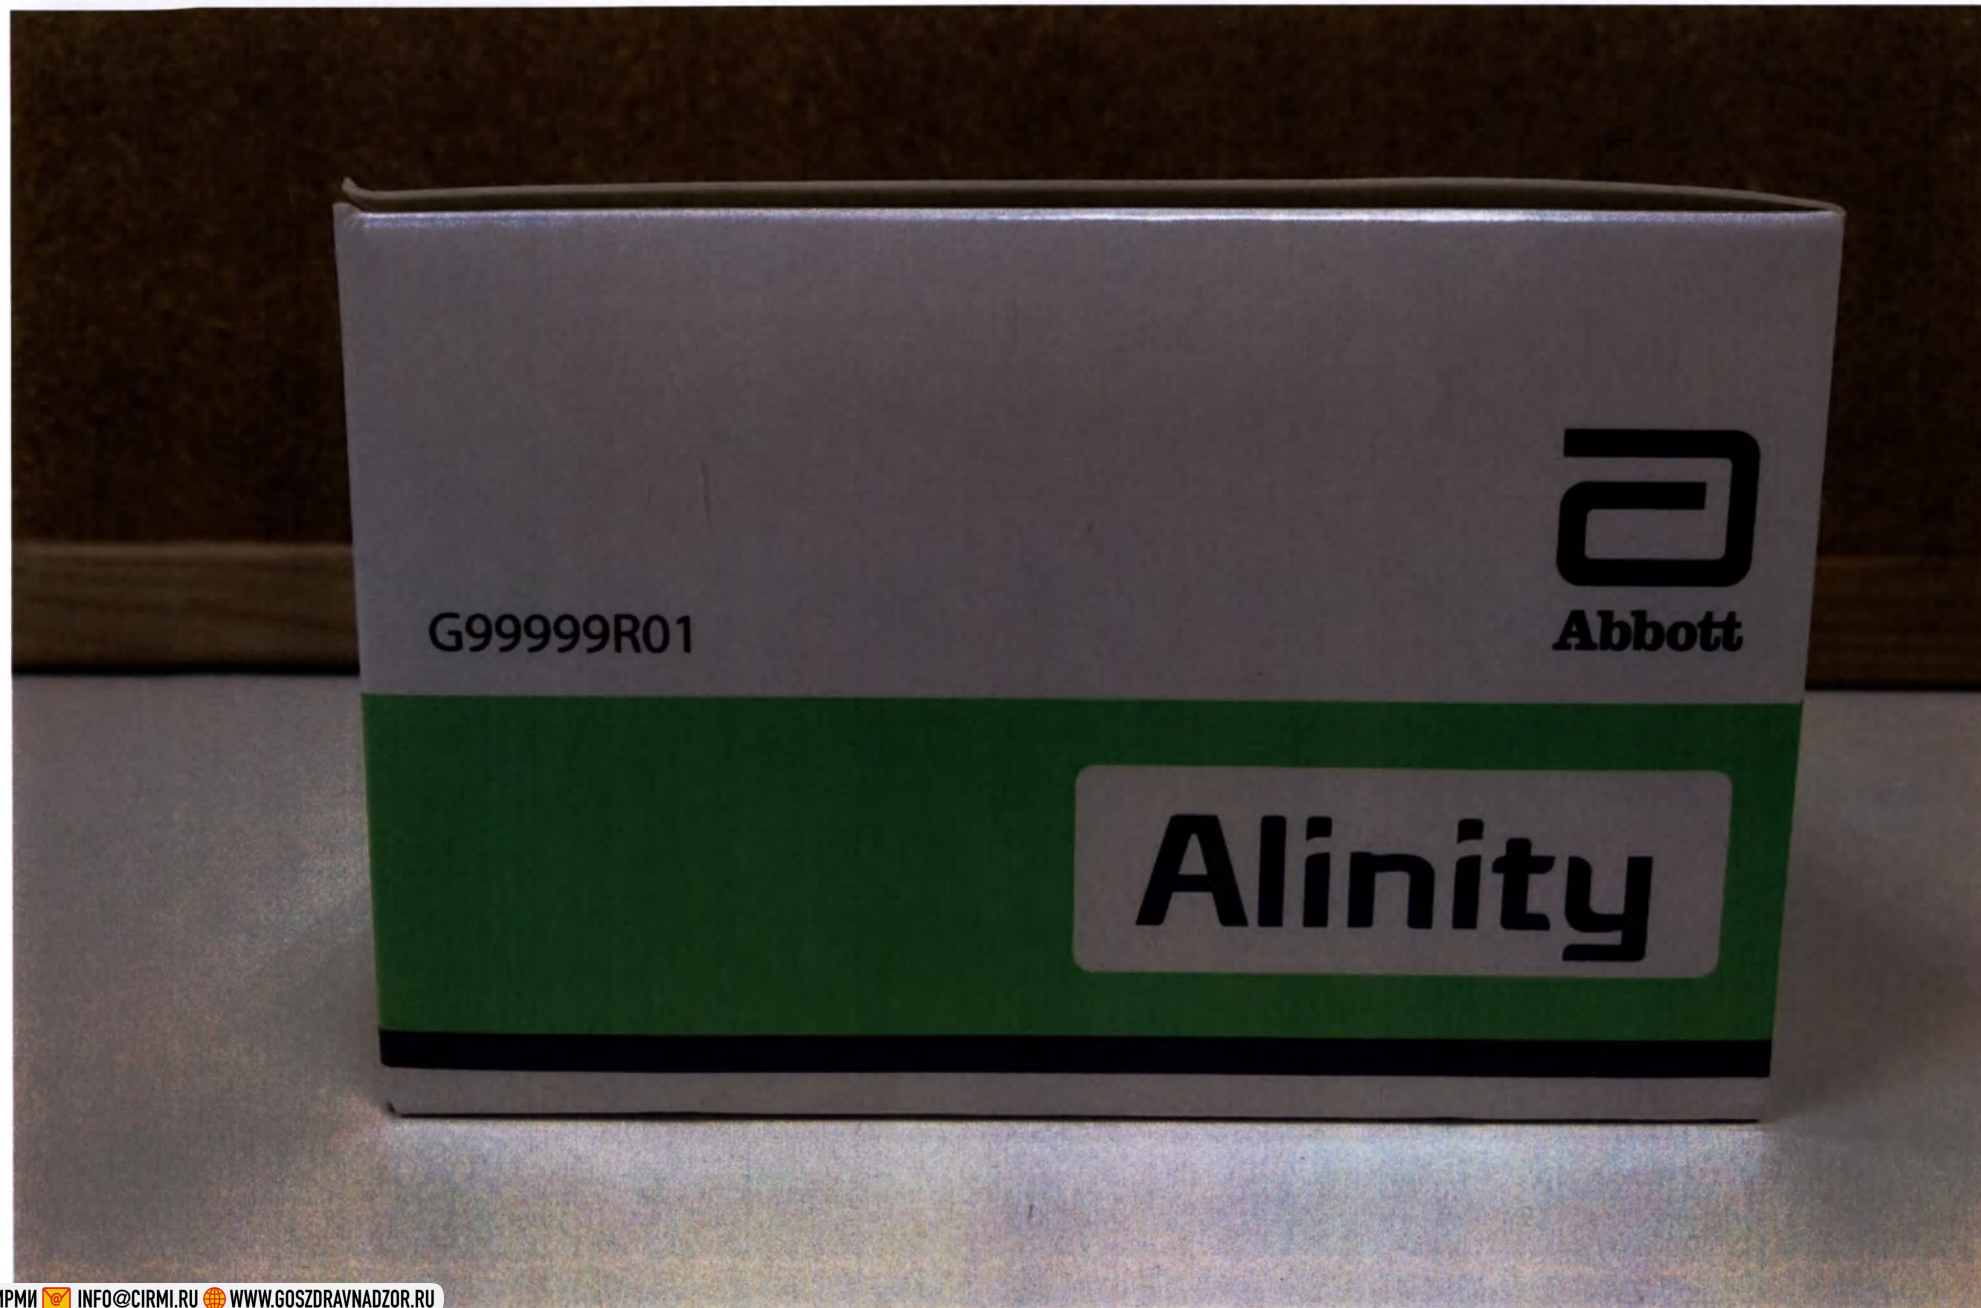




Фотографическое изображение общего вида МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), вид внутри

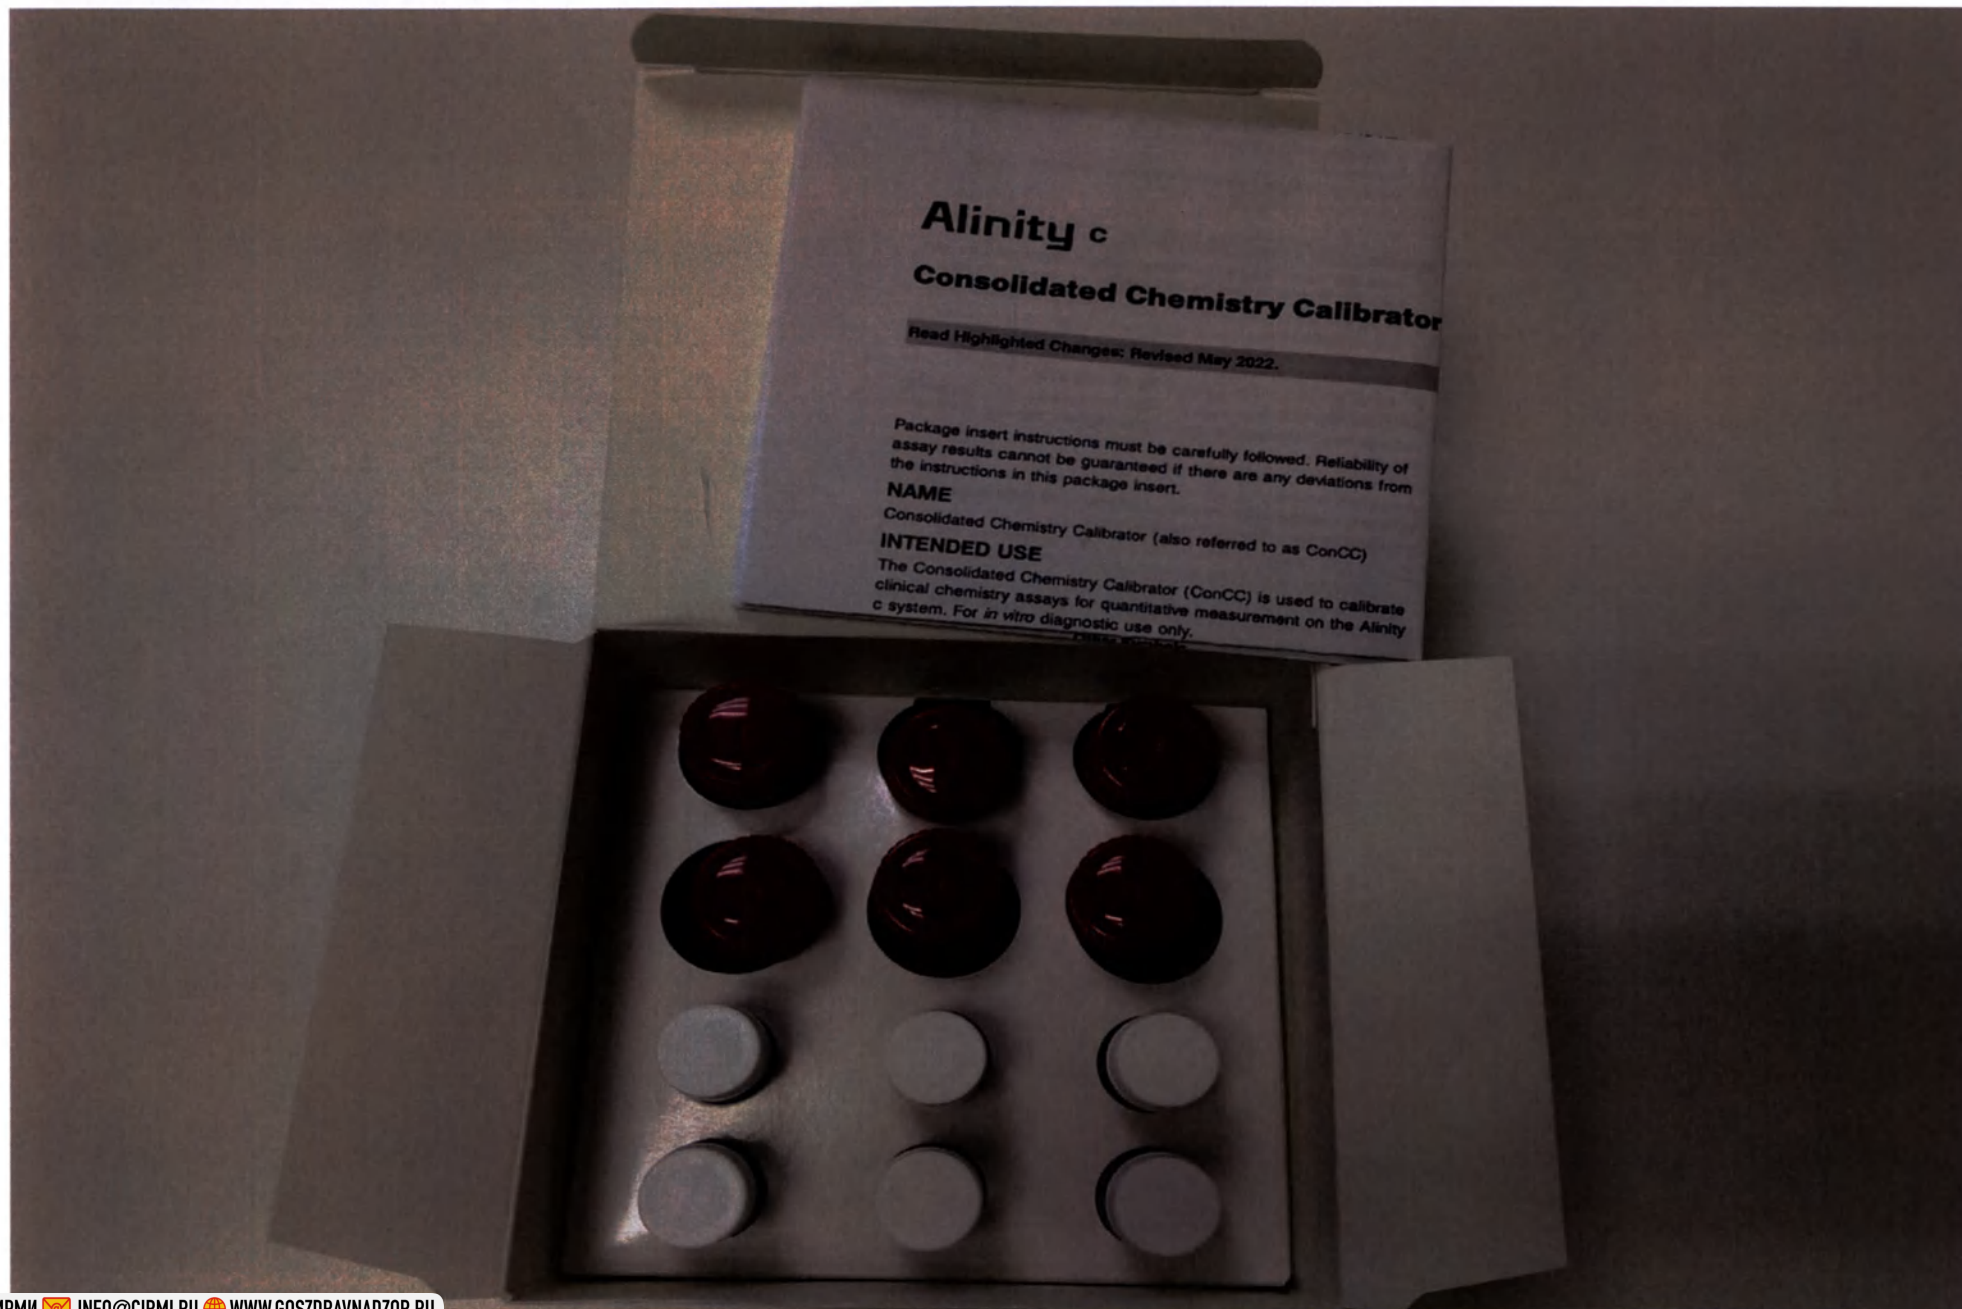


Фотографическое изображение общего вида МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), состав

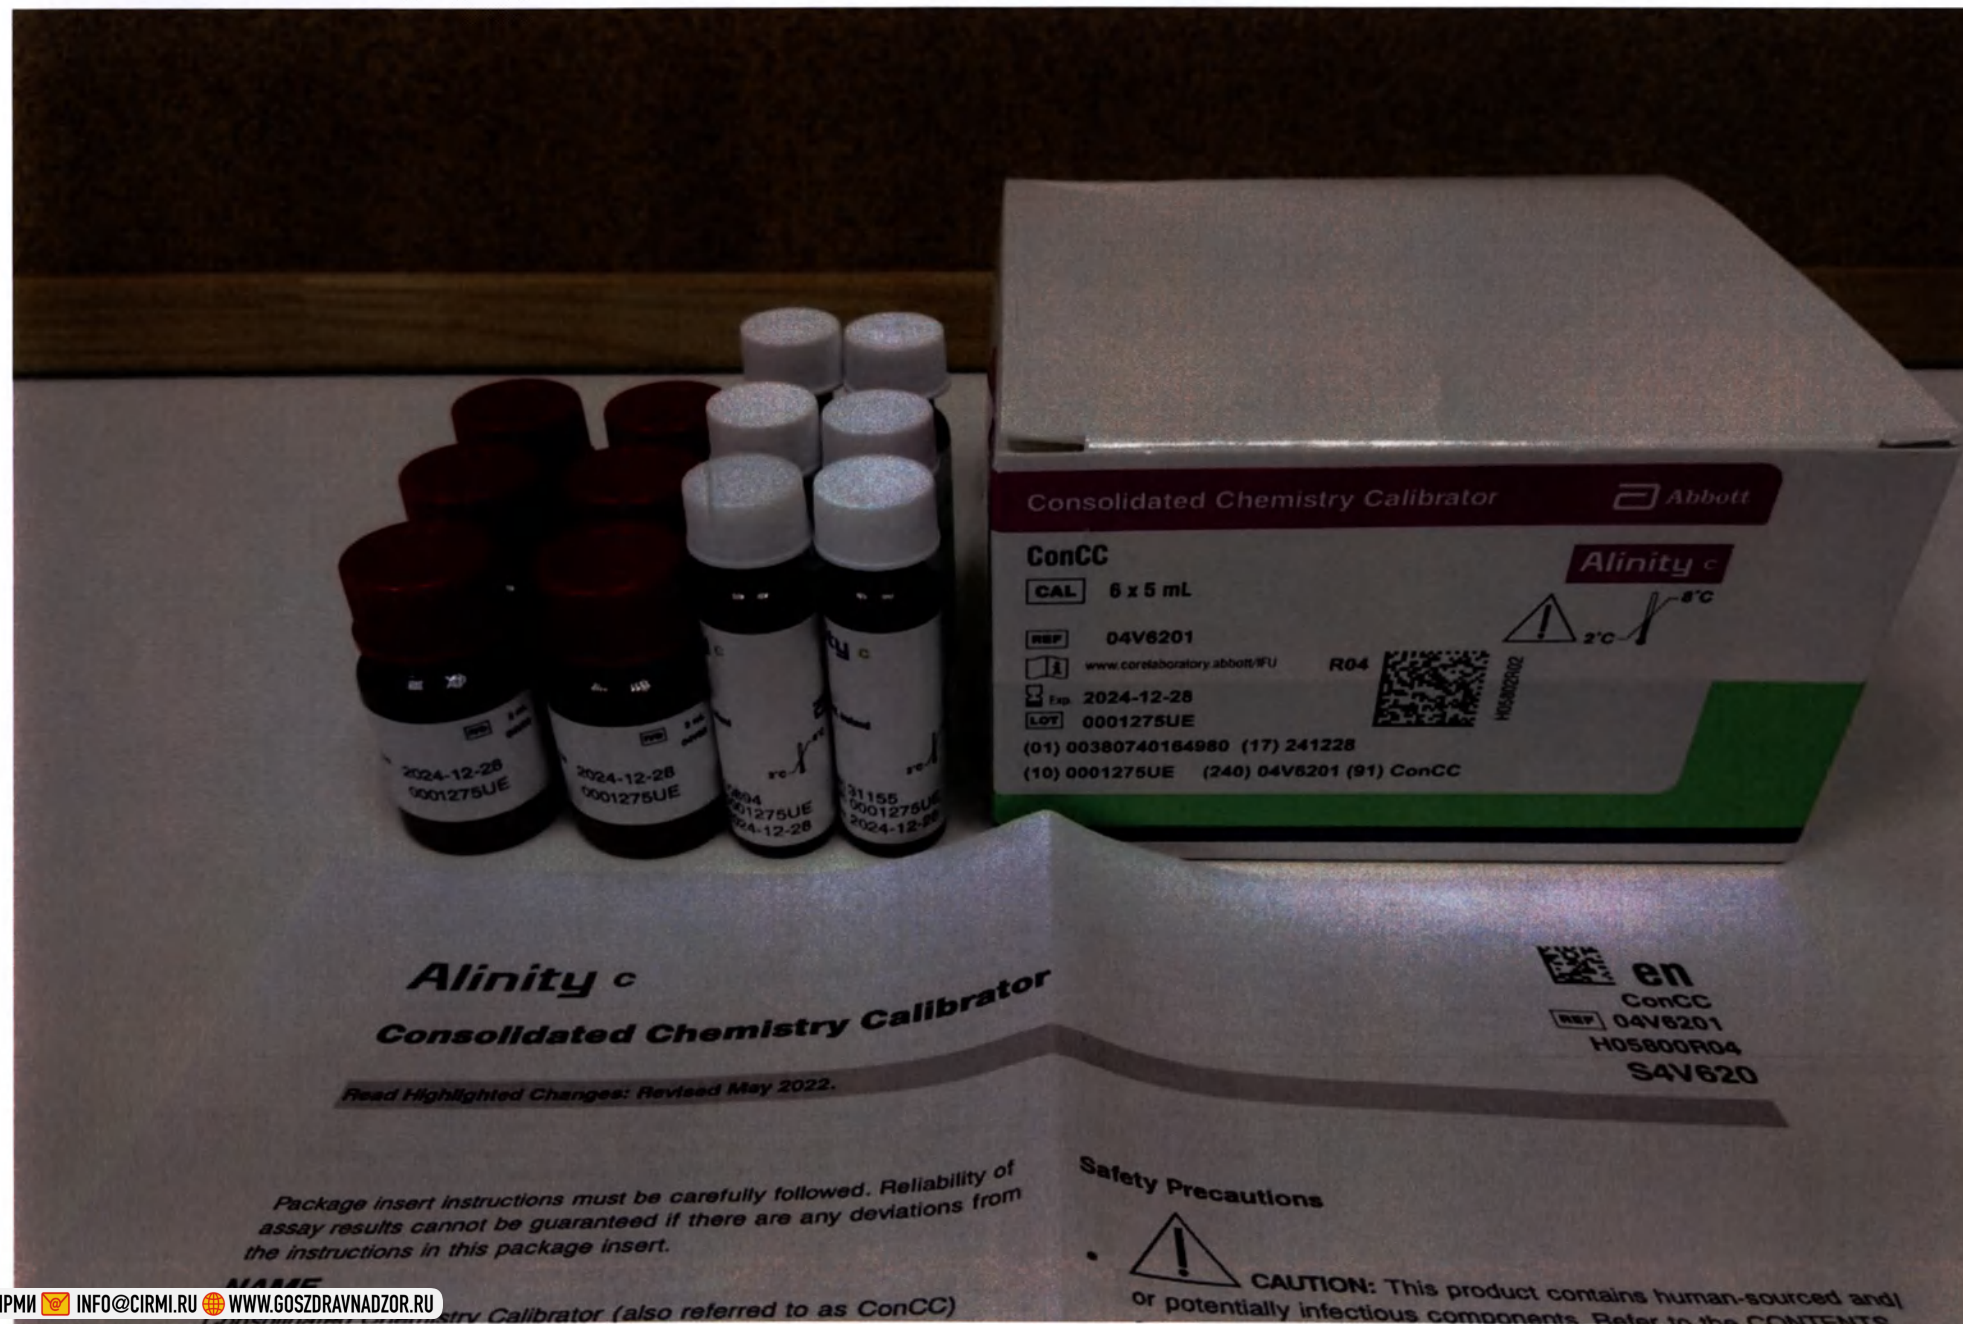

Фотографическое изображение МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), флакон ConCC Калибратор (Alinity c ConCC CAL)

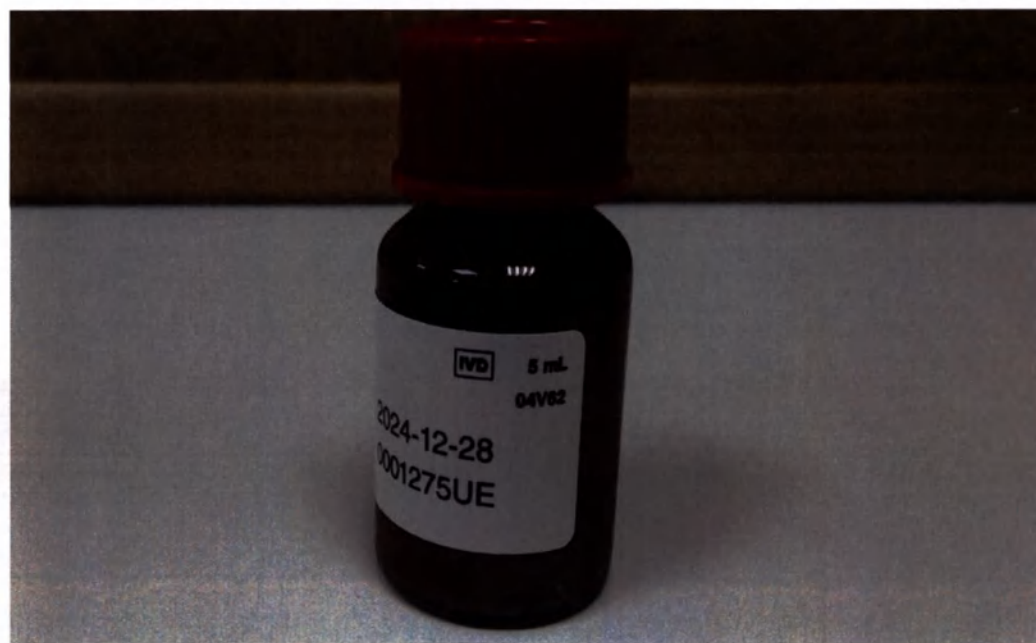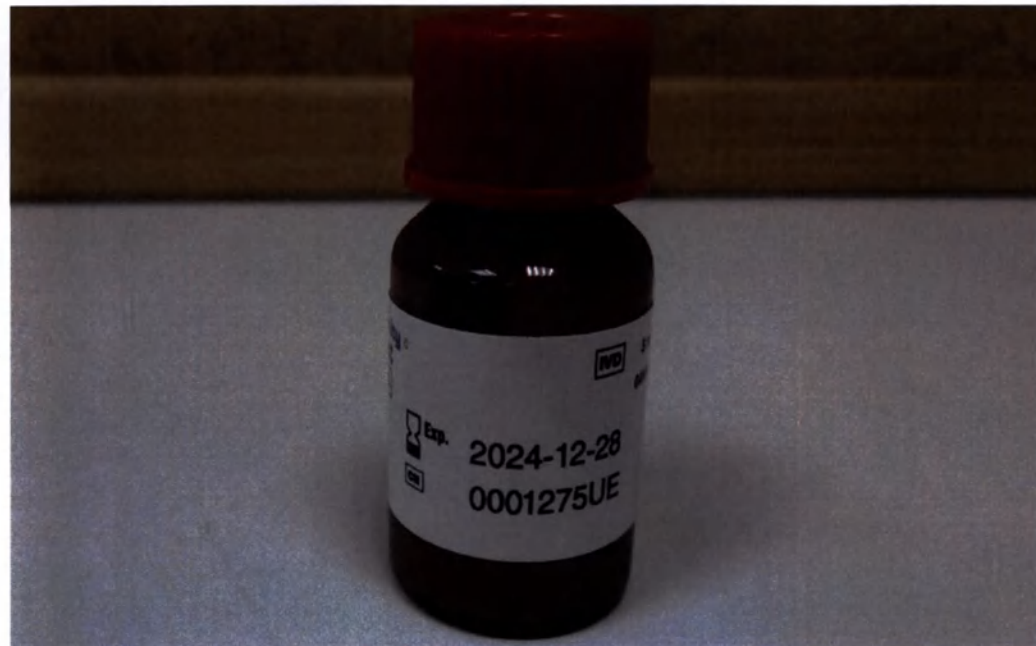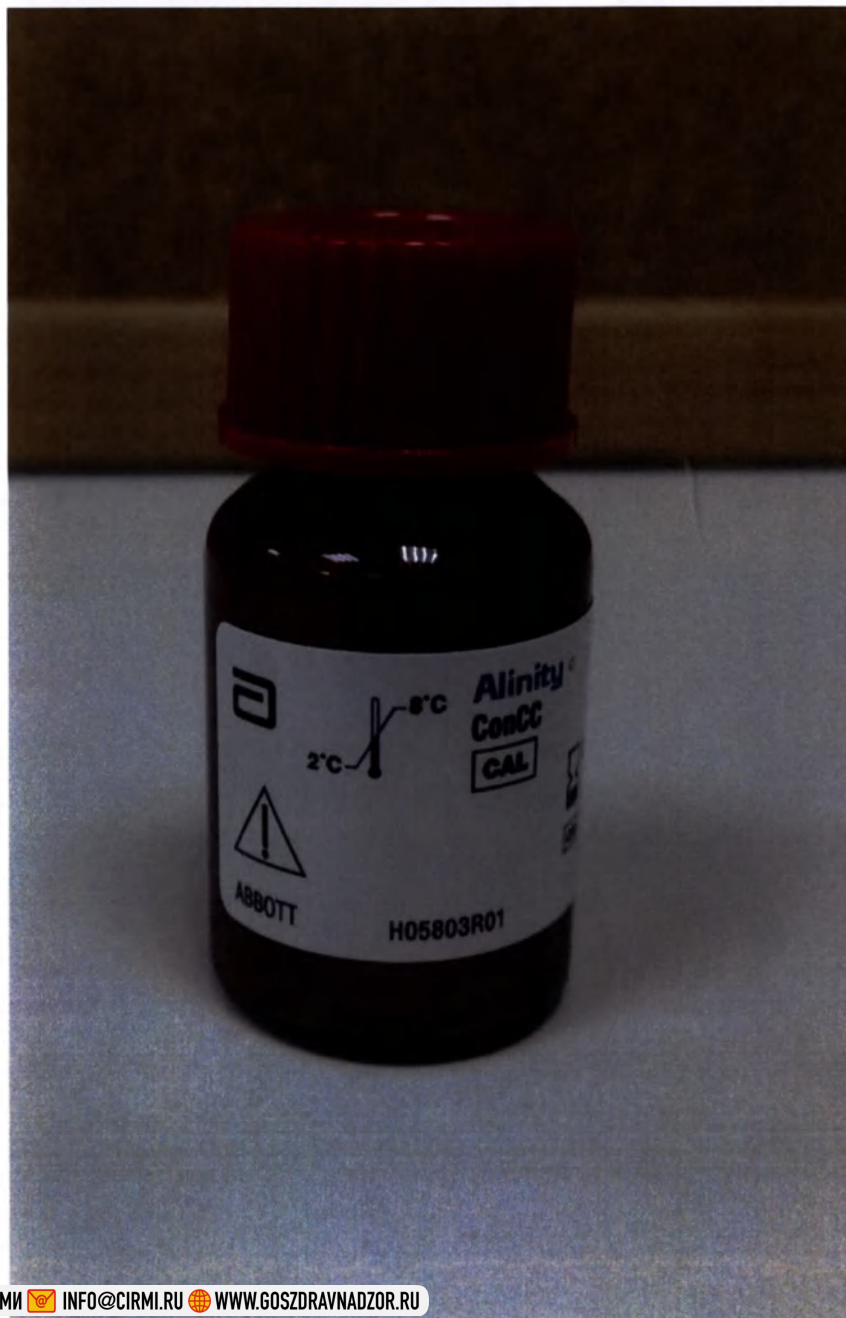

Фотографическое изображение МИ Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), флакон, маркированный штрихкодом, пустой

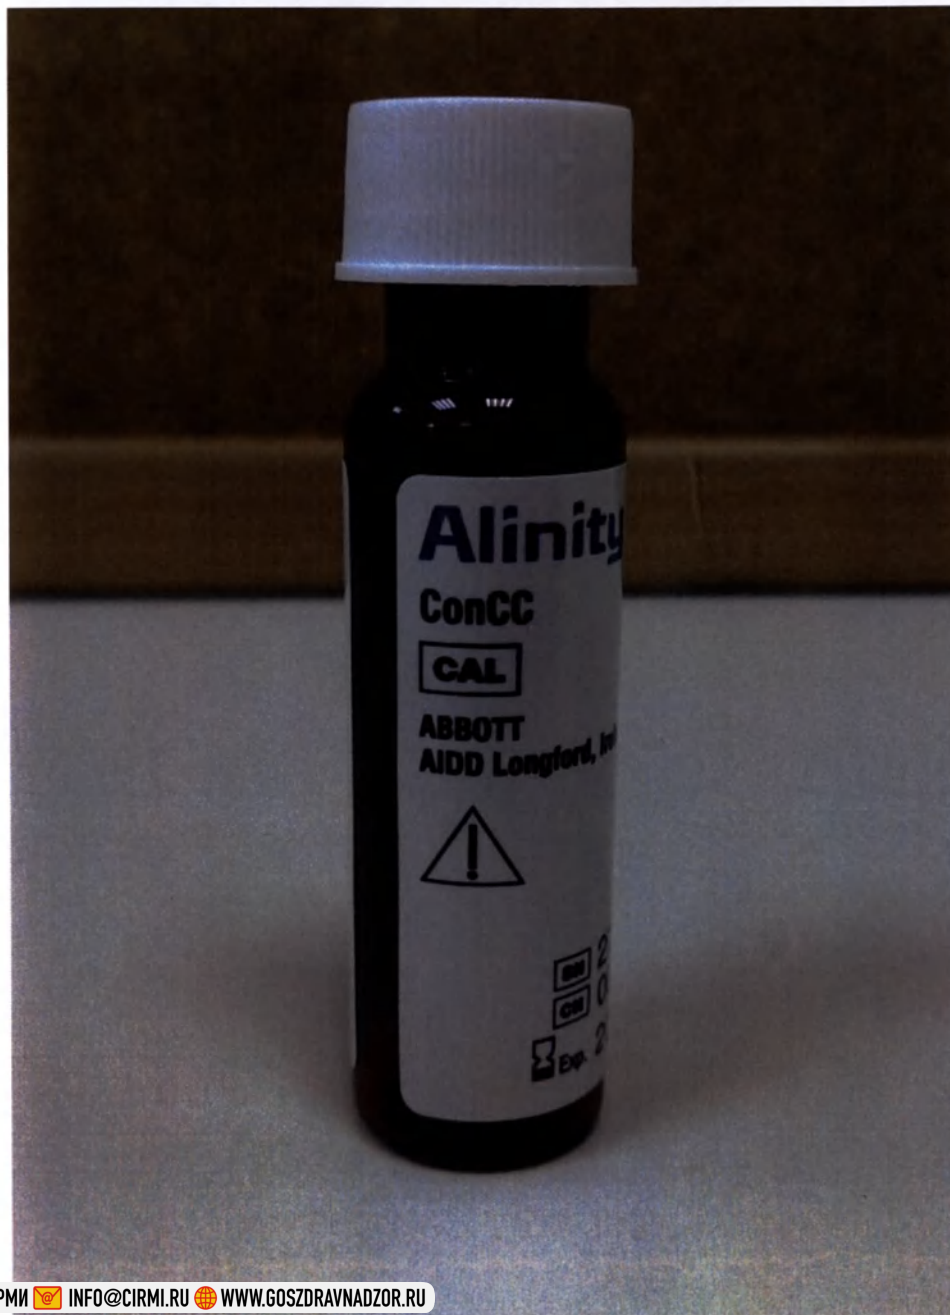

Подпись 





Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр. 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор консолидированный для обеспечения правильности
количественного определения аналитов клинической химии
в биологических жидкостях человека
на биохимических анализаторах Alinity c
«Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c
(Consolidated Chemistry Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), кат № 04V6201 для обращения на территории Российской Федерации



04V6201



Калибратор консолидированный для обеспечения правильности количественного определения аналитов клинической химии в биологических жидкостях человека на биохимических анализаторах Alinity c

«Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator)».

В составе: 1. КонСС Калибратор (Alinity c КонСС CAL) – 6 флаконов х 5,0 мл; 2. Флакон, маркированный штрихкодом, пустой - 6 шт.; 3. Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания/ РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции/ Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), кат № 04V6201, внешняя (потребительская) упаковка

ConCC

Consolidated Chemistry Calibrator

Abbott

REF

04V6201

www.corelaboratory.abbott/IFU

CAL

6 x 5 mL

ConCC

LOT

Exp.



Версия

Двумерный Штрихкод

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ИЗДЕЛИЯ (код)

Abbott Ireland

Diagnostics Division

Lisnamuck, Longford

Co. Longford

Ireland

+353-43-3331000



2°C

8°C

MANUFACTURED FOR

Abbott Laboratories

IVD



PRODUCT OF GB

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

To calibrate clinical chemistry assays for quantitative measurement on the Alinity c system.

The [CAL] is prepared from lyophilized human serum.

Infection Risk.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories,

Abbott Park, IL 60064 USA

Alinity c






H05802R02

 000 ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Калибратор аналитов клинической химии консолидированный для Alinity c (Consolidated Chemistry Calibrator), кат № 04V6201, (внутренняя упаковка)

1. ConCC Калибратор (Alinity c ConCC CAL):

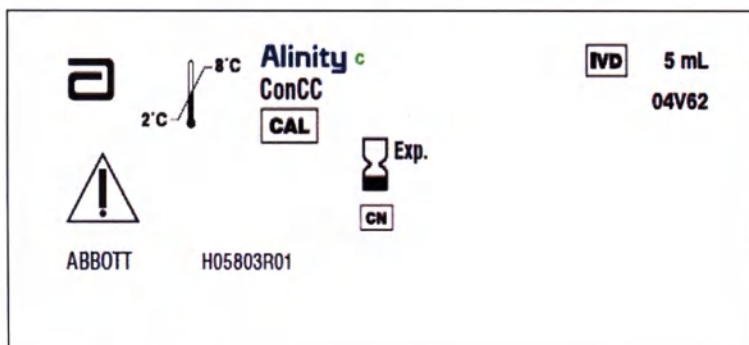

2. Флакон, маркированный штрихкодом, пустой:



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

