

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Ингаляторы-небулайзеры «Armed» в вариантах исполнения»,

производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.), Китай

- I. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403А (см. Приложение).
 - II. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403В (см. Приложение).
 - III. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403С (см. Приложение).
 - IV. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403А1 (см. Приложение).
 - V. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403D (см. Приложение).
 - VI. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Н (см. Приложение).
 - VII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Е (см. Приложение).
 - VIII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403М (см. Приложение).
 - IX. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Т (см. Приложение).
 - X. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403К (см. Приложение).
 - XI. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405А (см. Приложение).
 - XII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405В (см. Приложение).
 - XIII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 407А (см. Приложение).
 - XIV. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S (см. Приложение).
 - XV. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403А
 - XVI. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403В
 - XVII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403С
 - XVIII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403А1
 - XIX. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403D
 - XX. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Н
 - XXI. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Е
 - XXII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403М
 - XXIII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403Т
 - XXIV. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403К
 - XXV. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405А
 - XXVI. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405В
 - XXVII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 407А
 - XXVIII. Макет этикетки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S
 - XXIX. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403А
 - XXX. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403В
- Электронная копия оформлена Центром испытаний и регистрации медицинских изделий

- XXXII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403AI
- XXXIII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403D
- XXXIV. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403H
- XXXV. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403E
- XXXVI. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403M
- XXXVII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403T
- XXXVIII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403K
- XXXIX. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405A
- XL. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405B
- XLI. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 407A
- XLII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)


(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)




от имени _____ Общества с ограниченной ответственностью «Опора» (ООО «Опора»)
(наименование организации-заявителя)

Приложение


I. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403A:

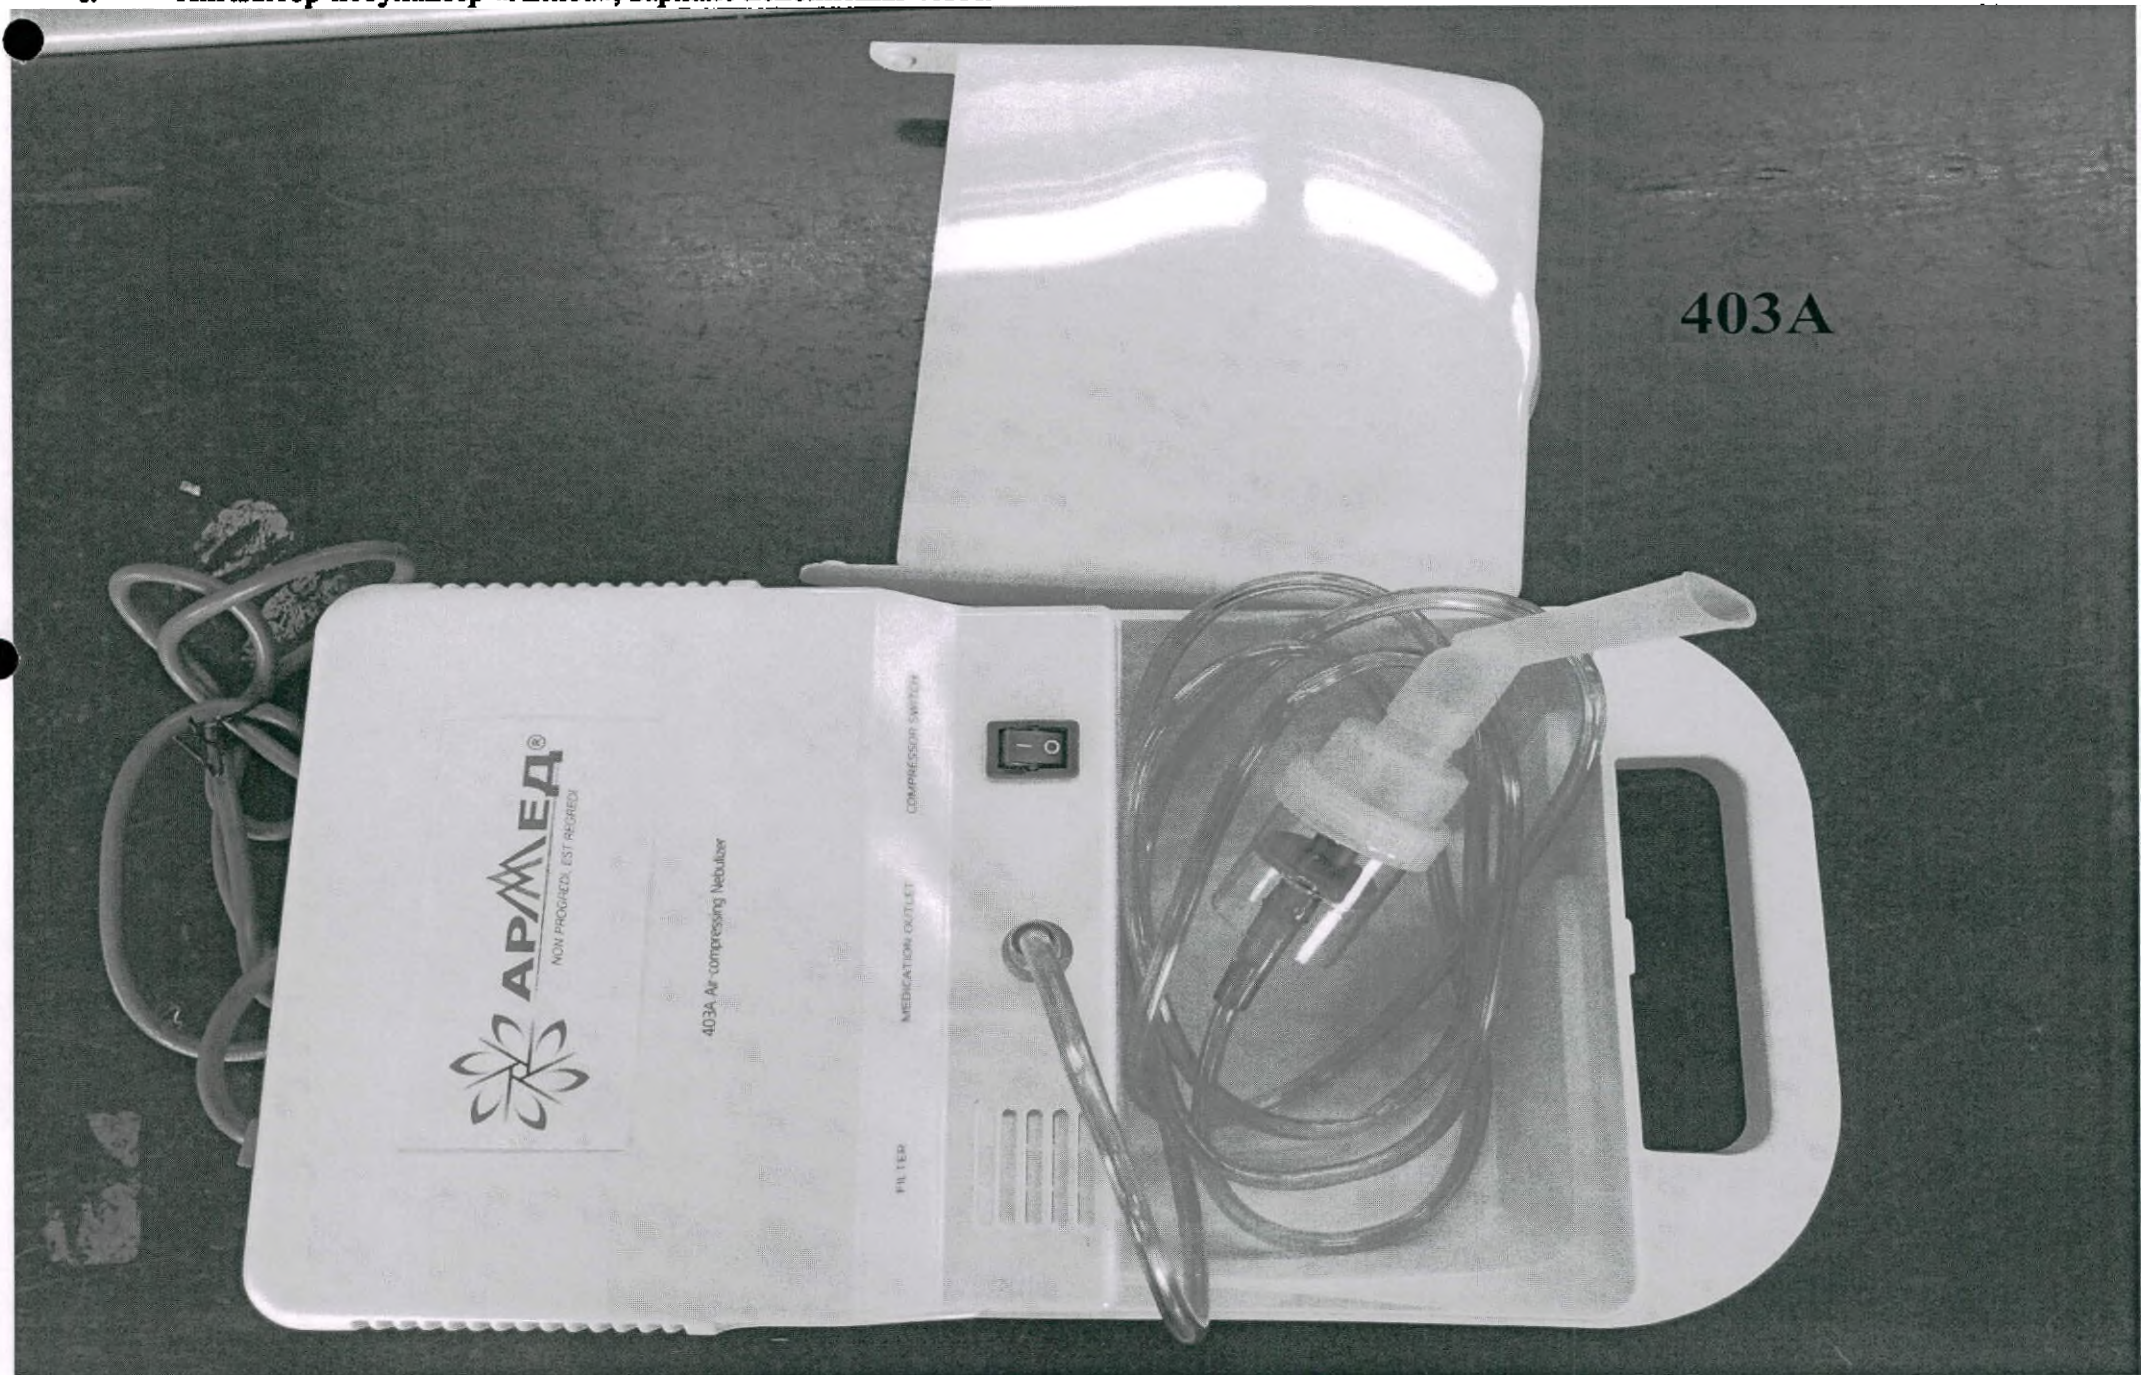

II. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403B

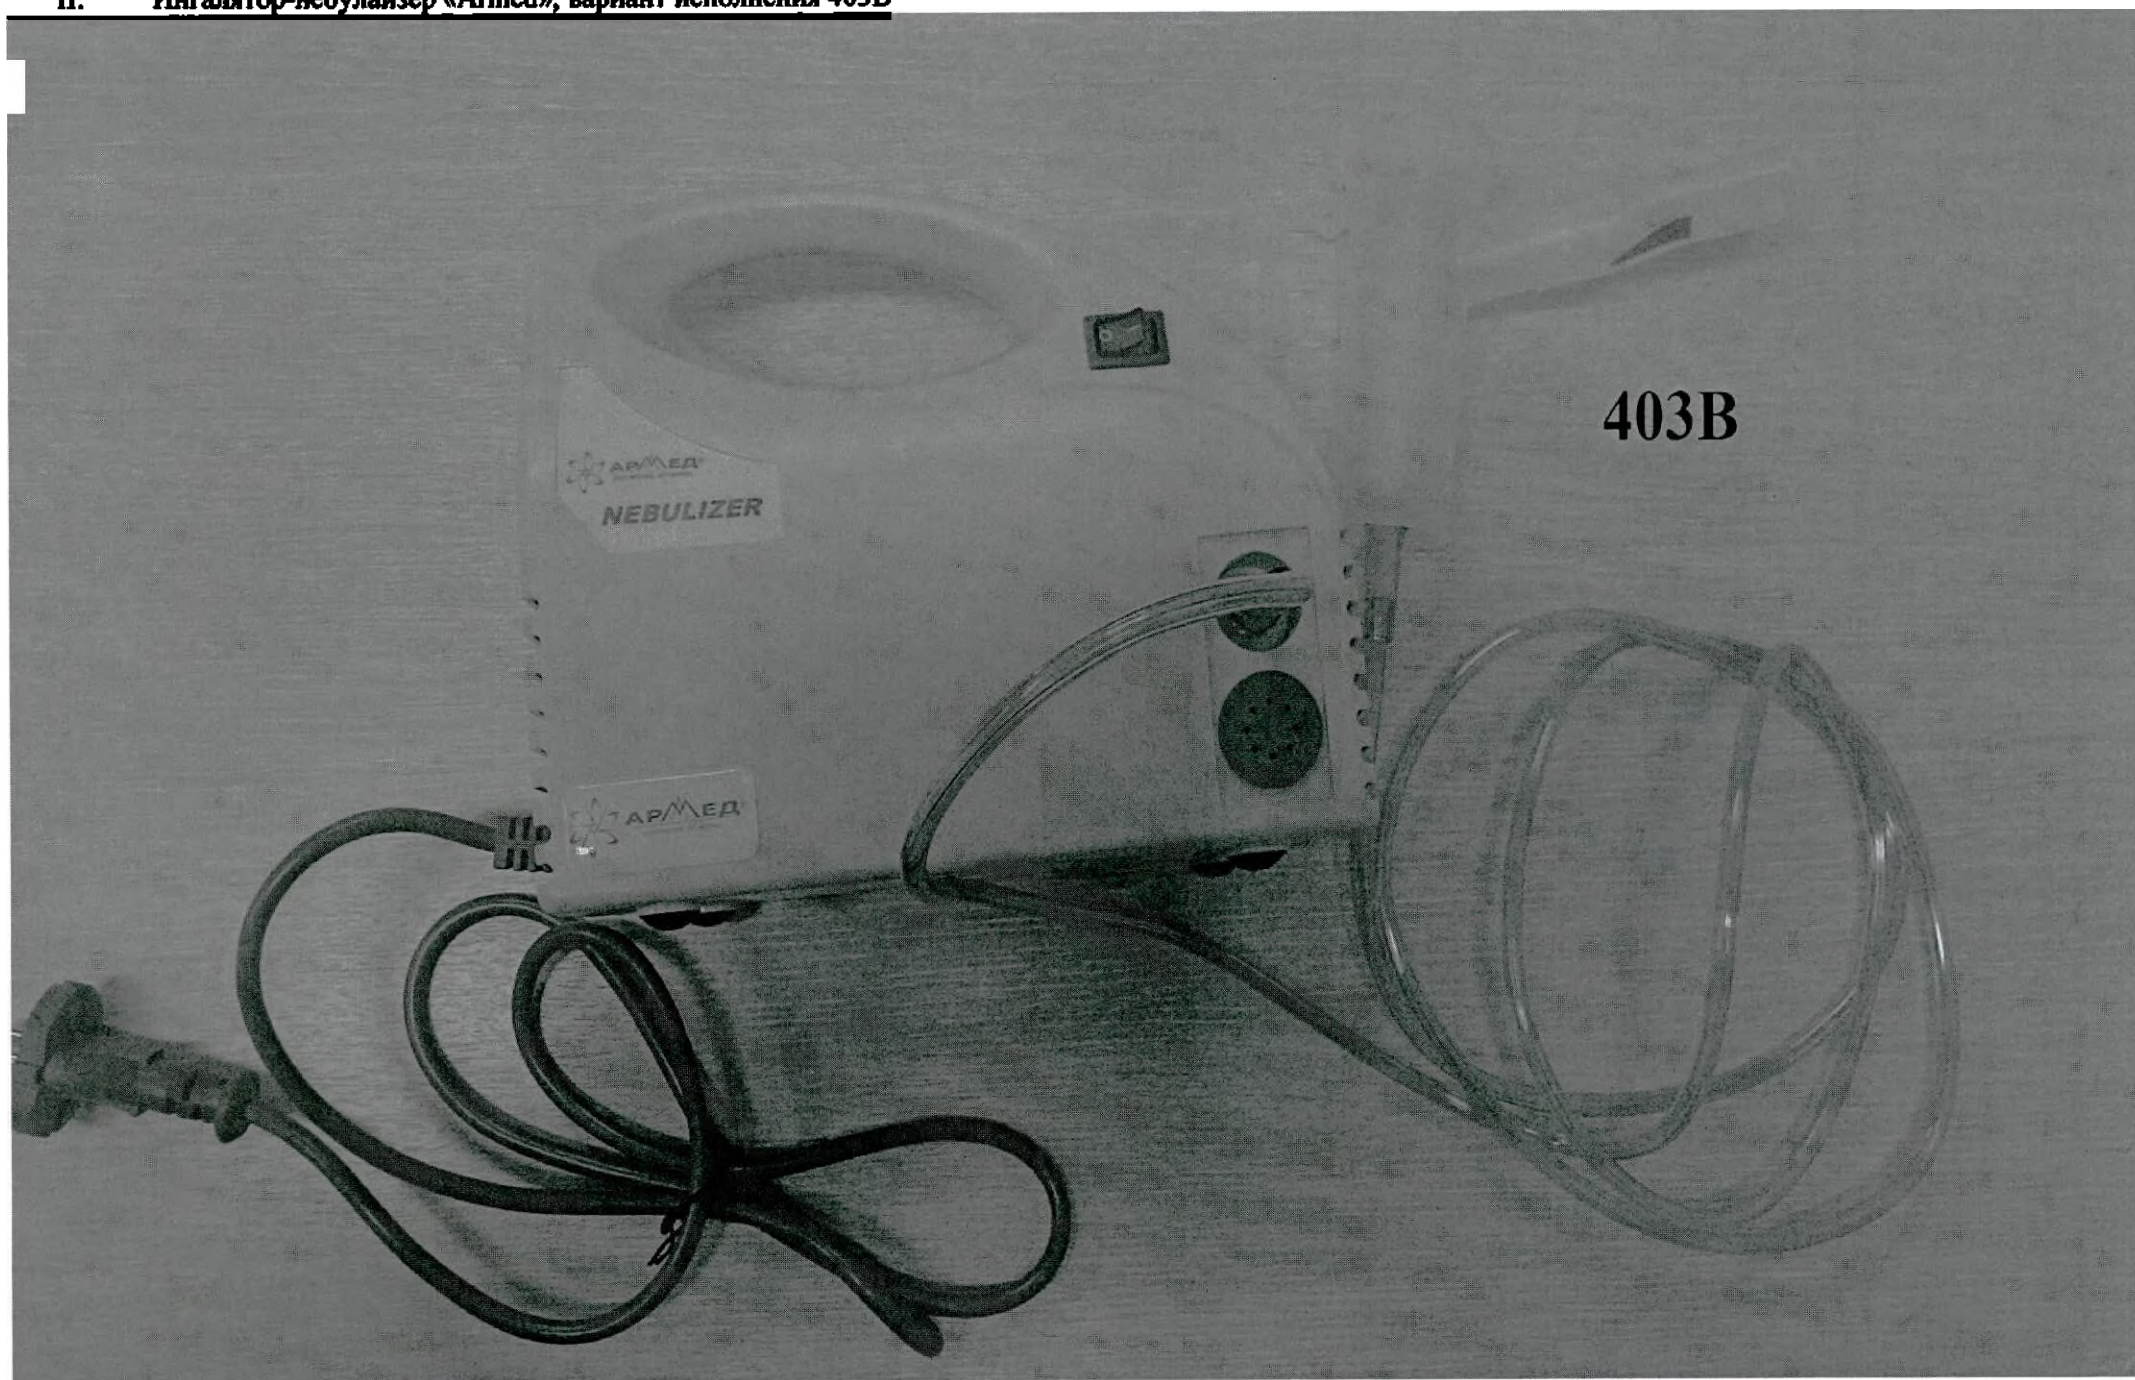

III. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403C

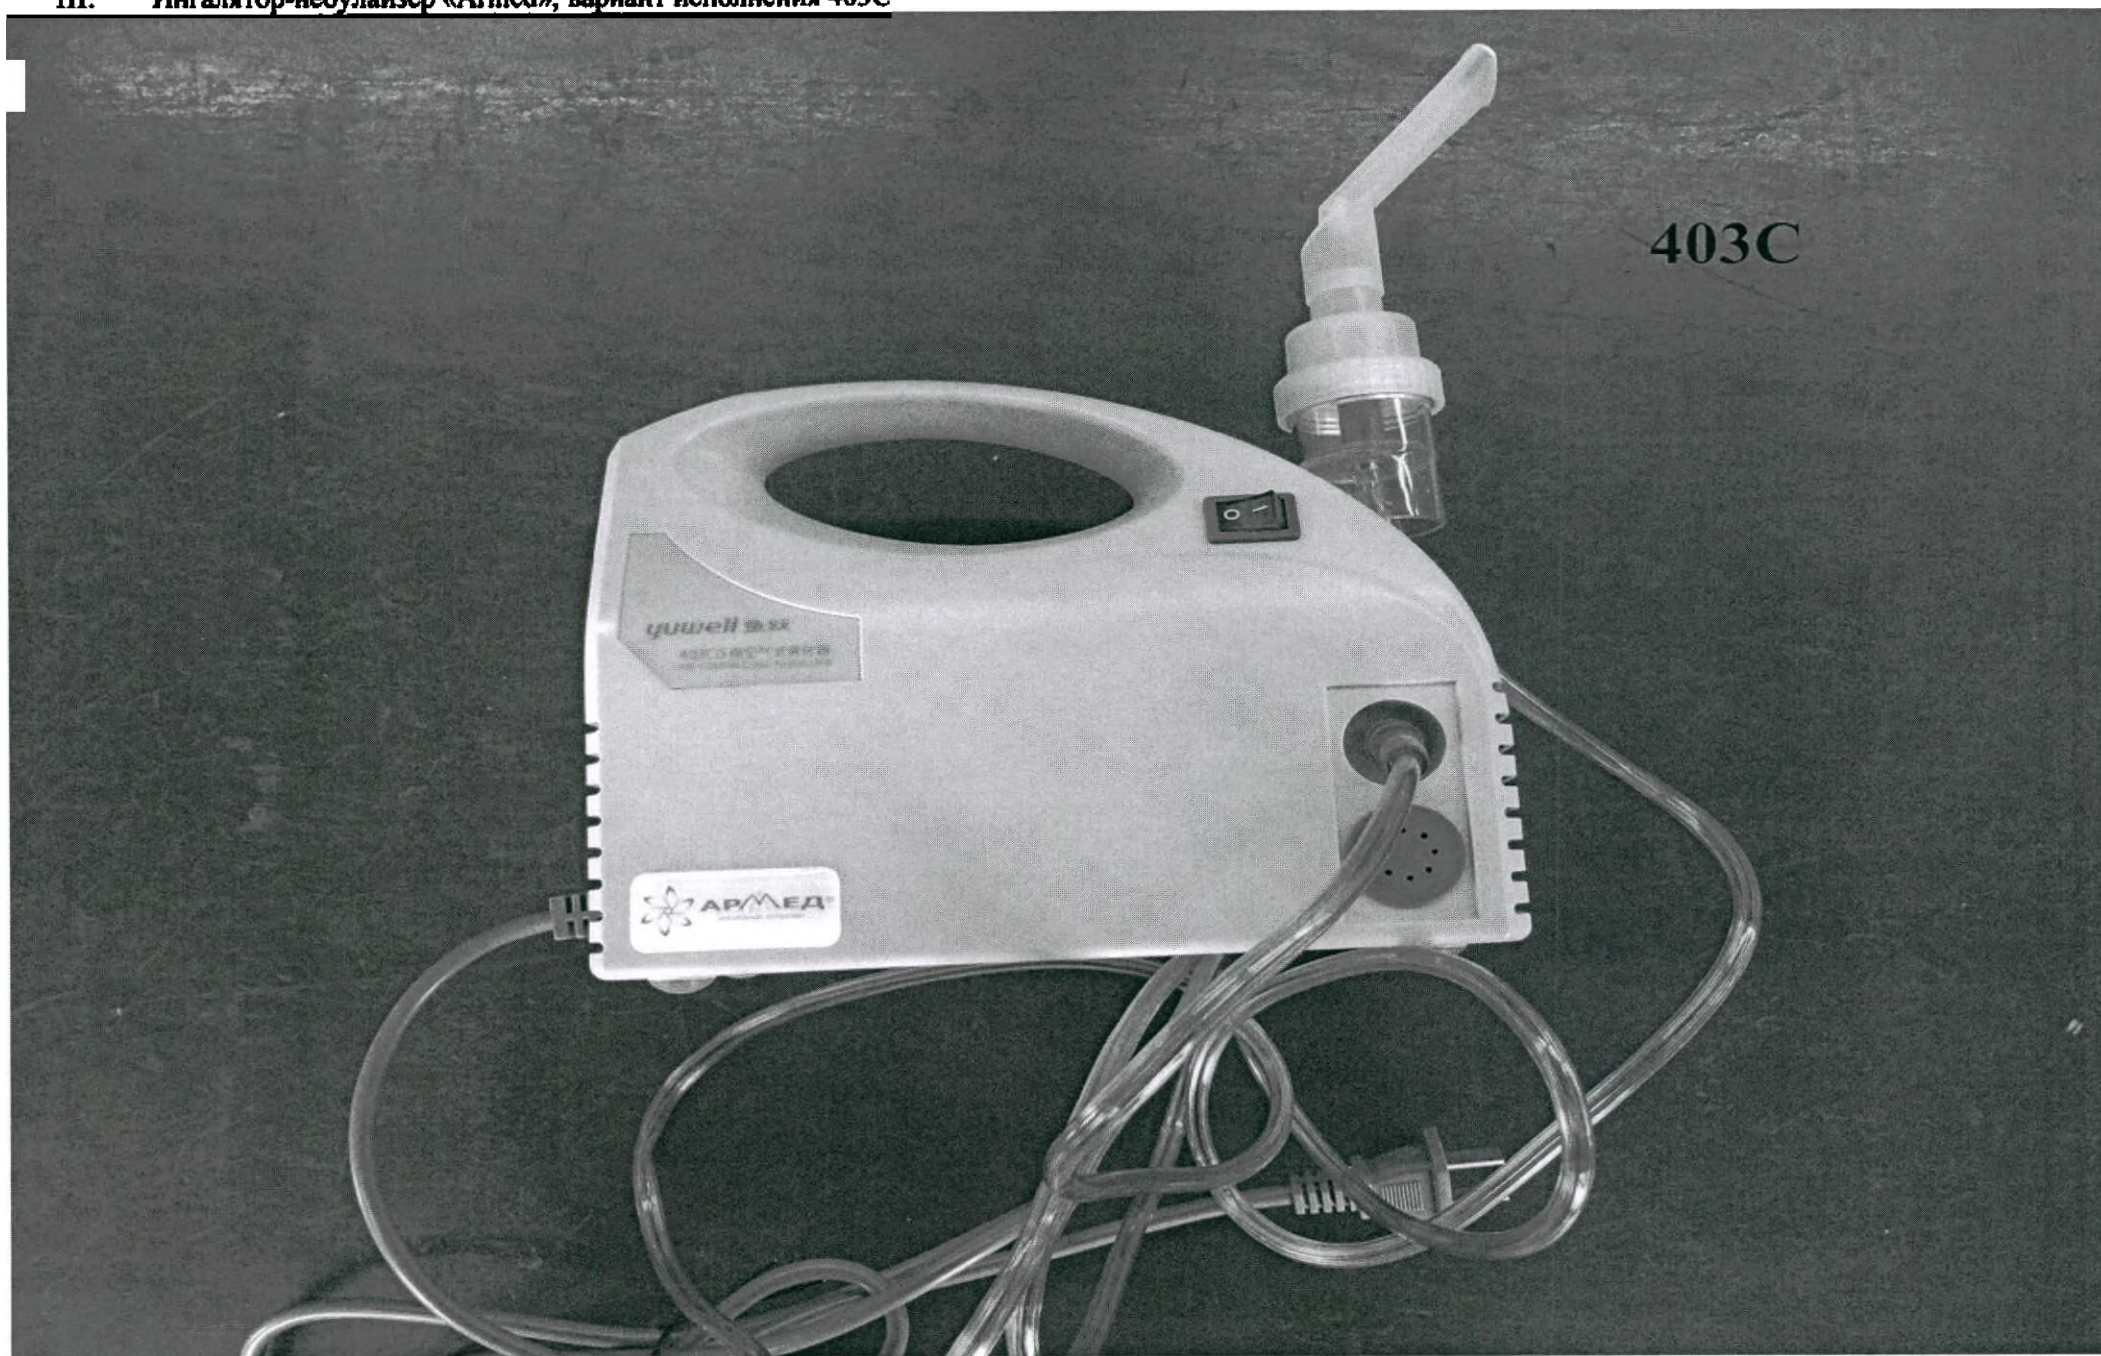


IV. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403AI




403AI

V. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403D

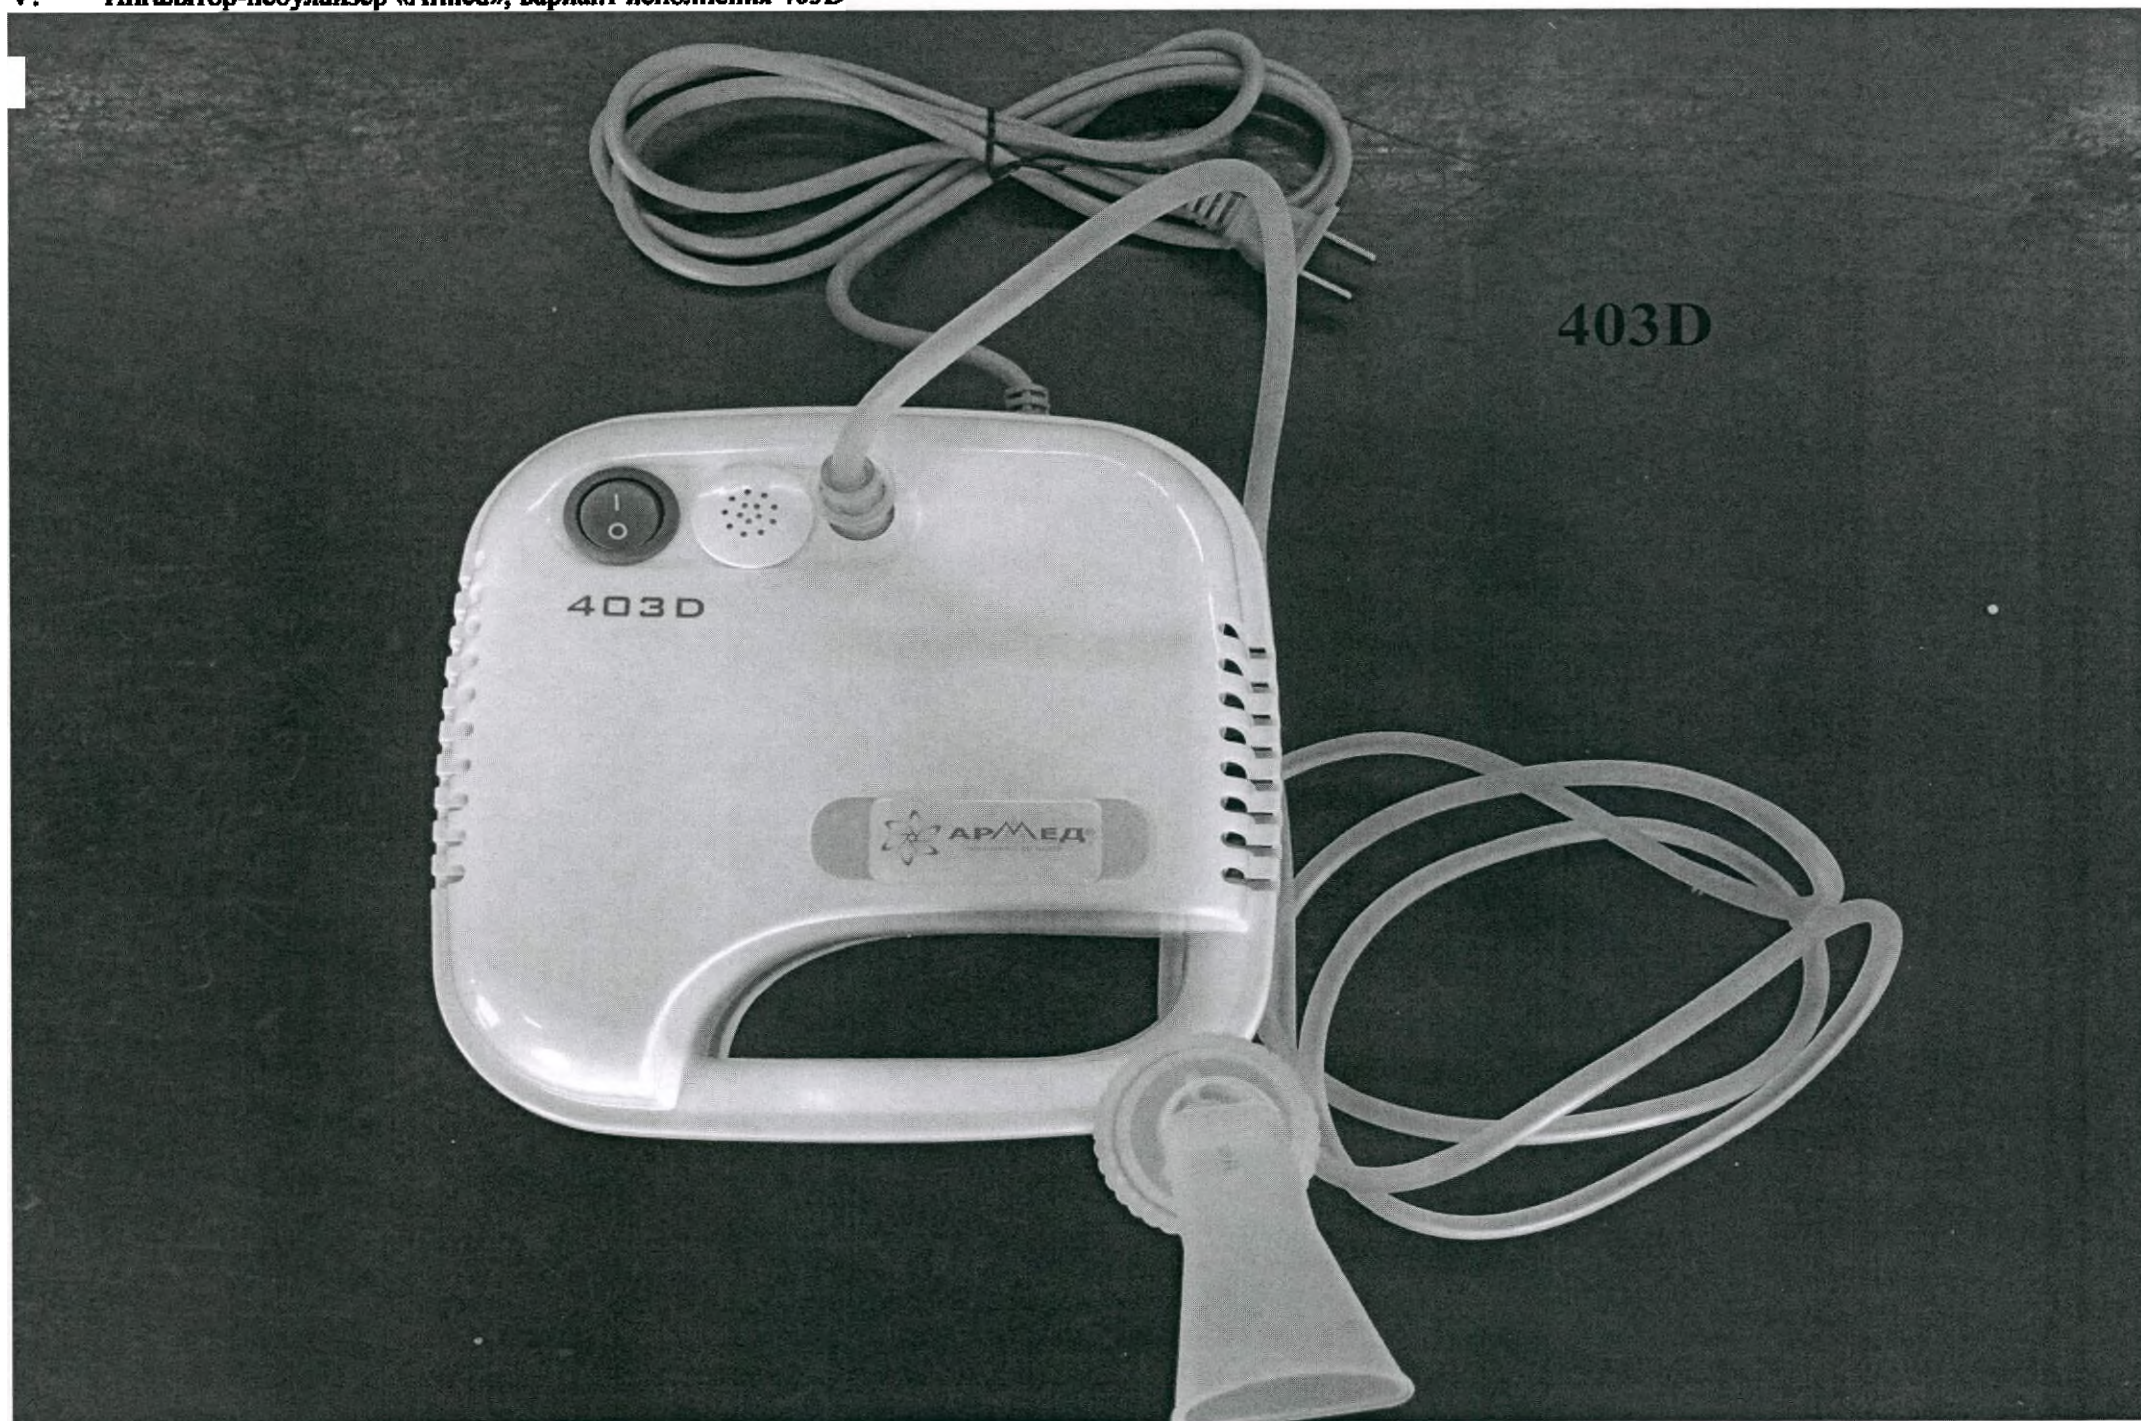


VI. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403H

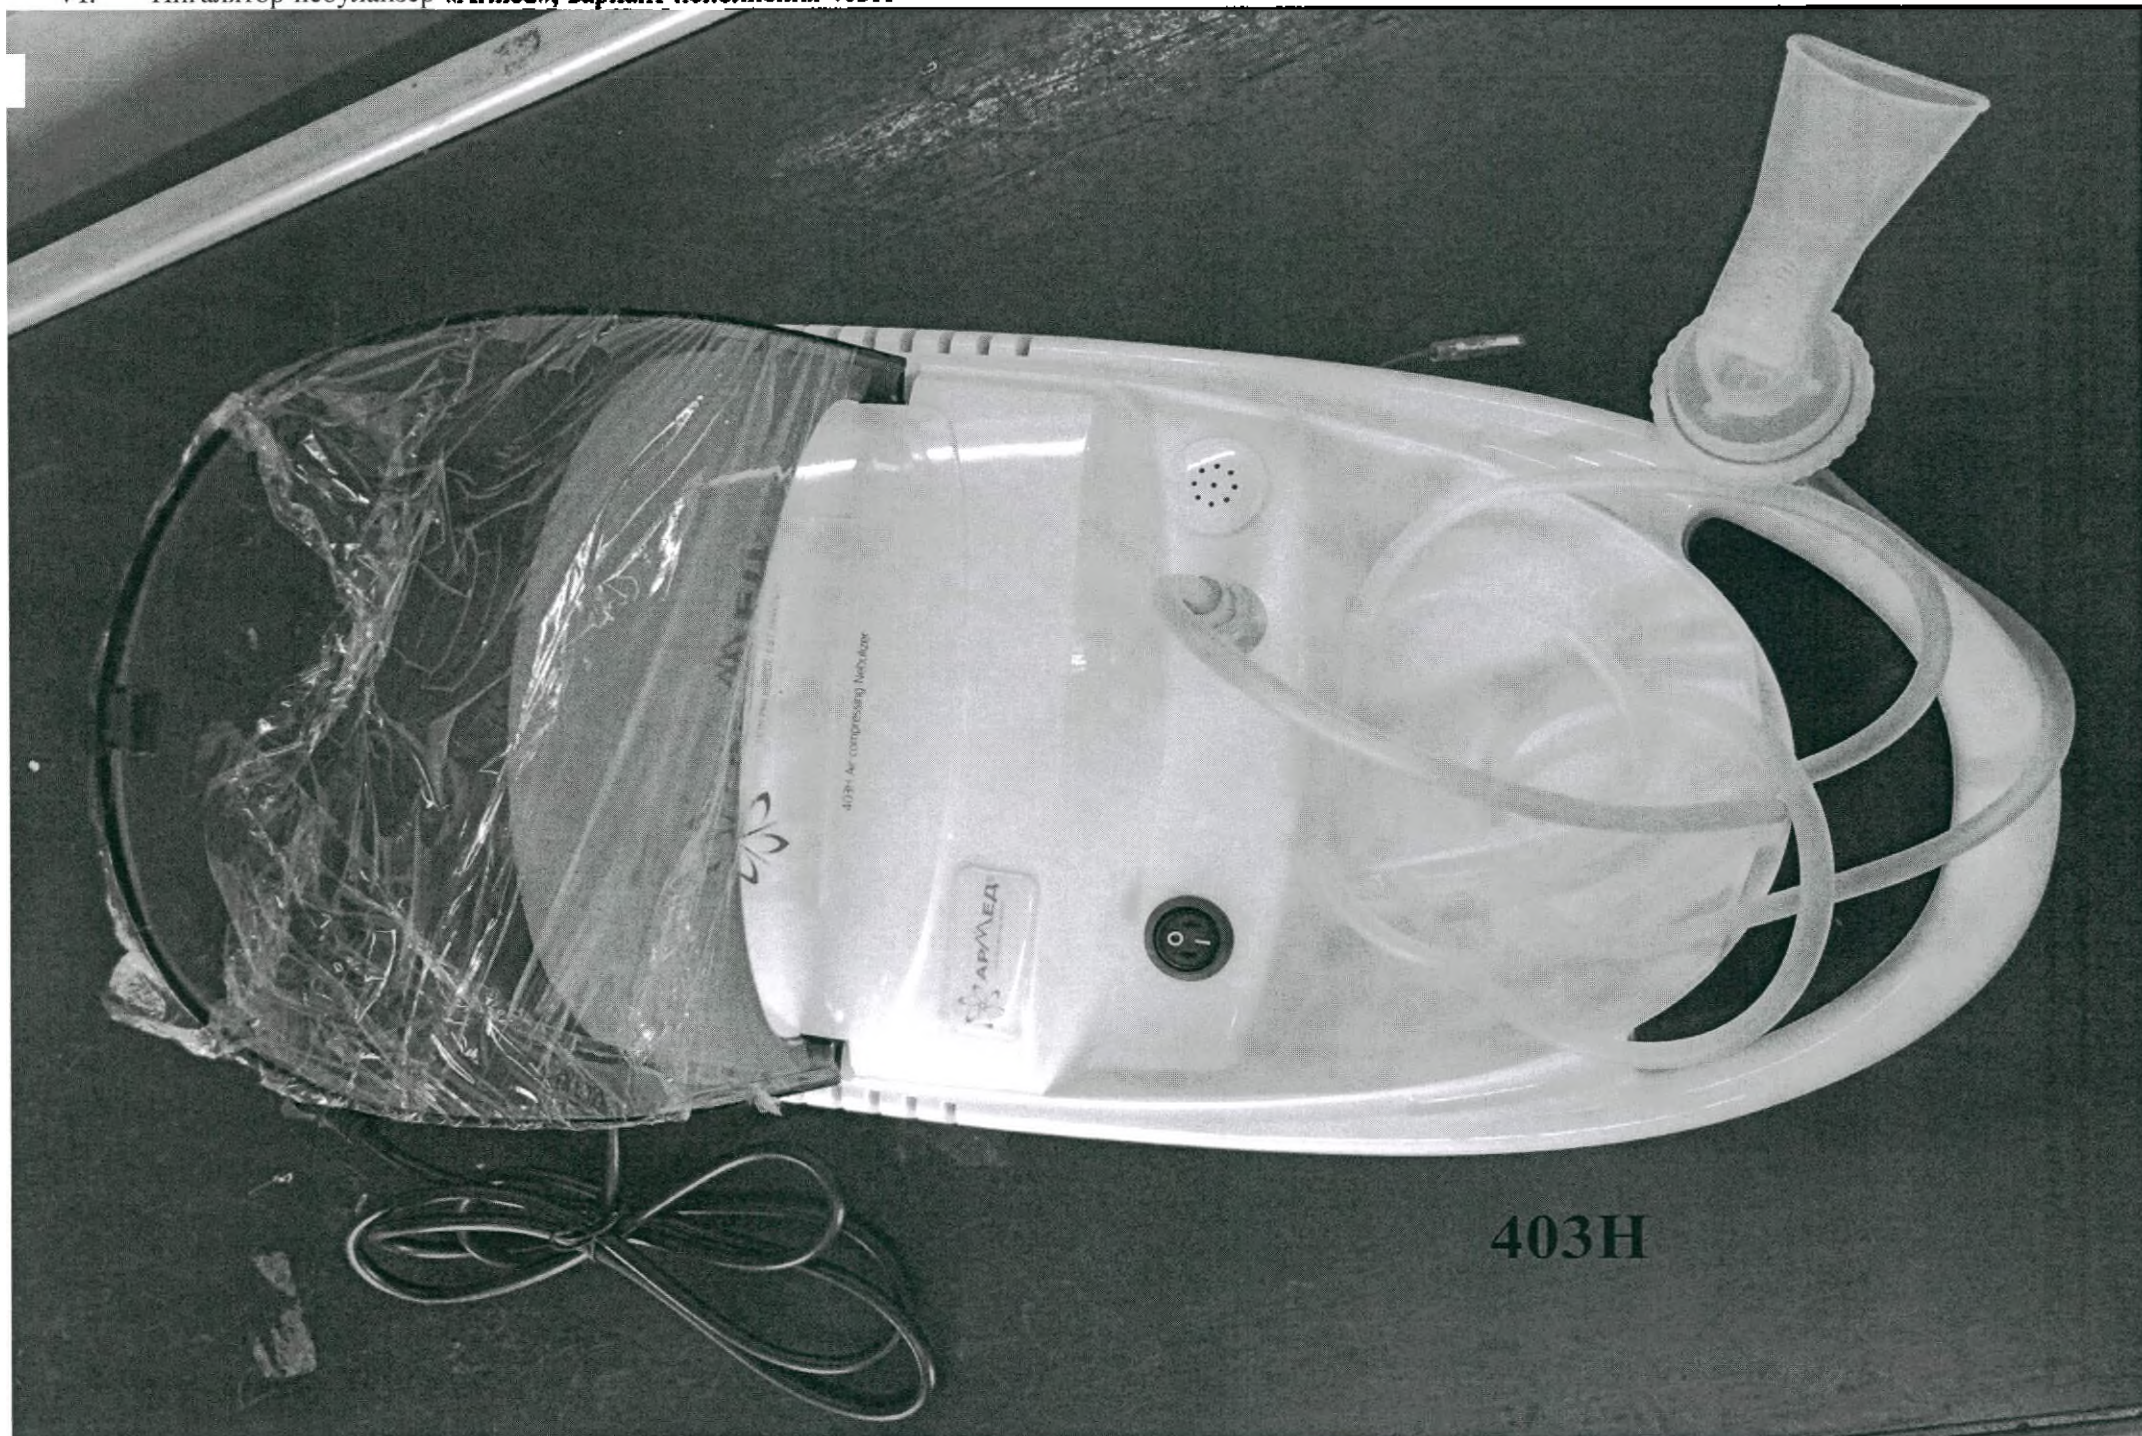


VII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403E



VIII. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403M

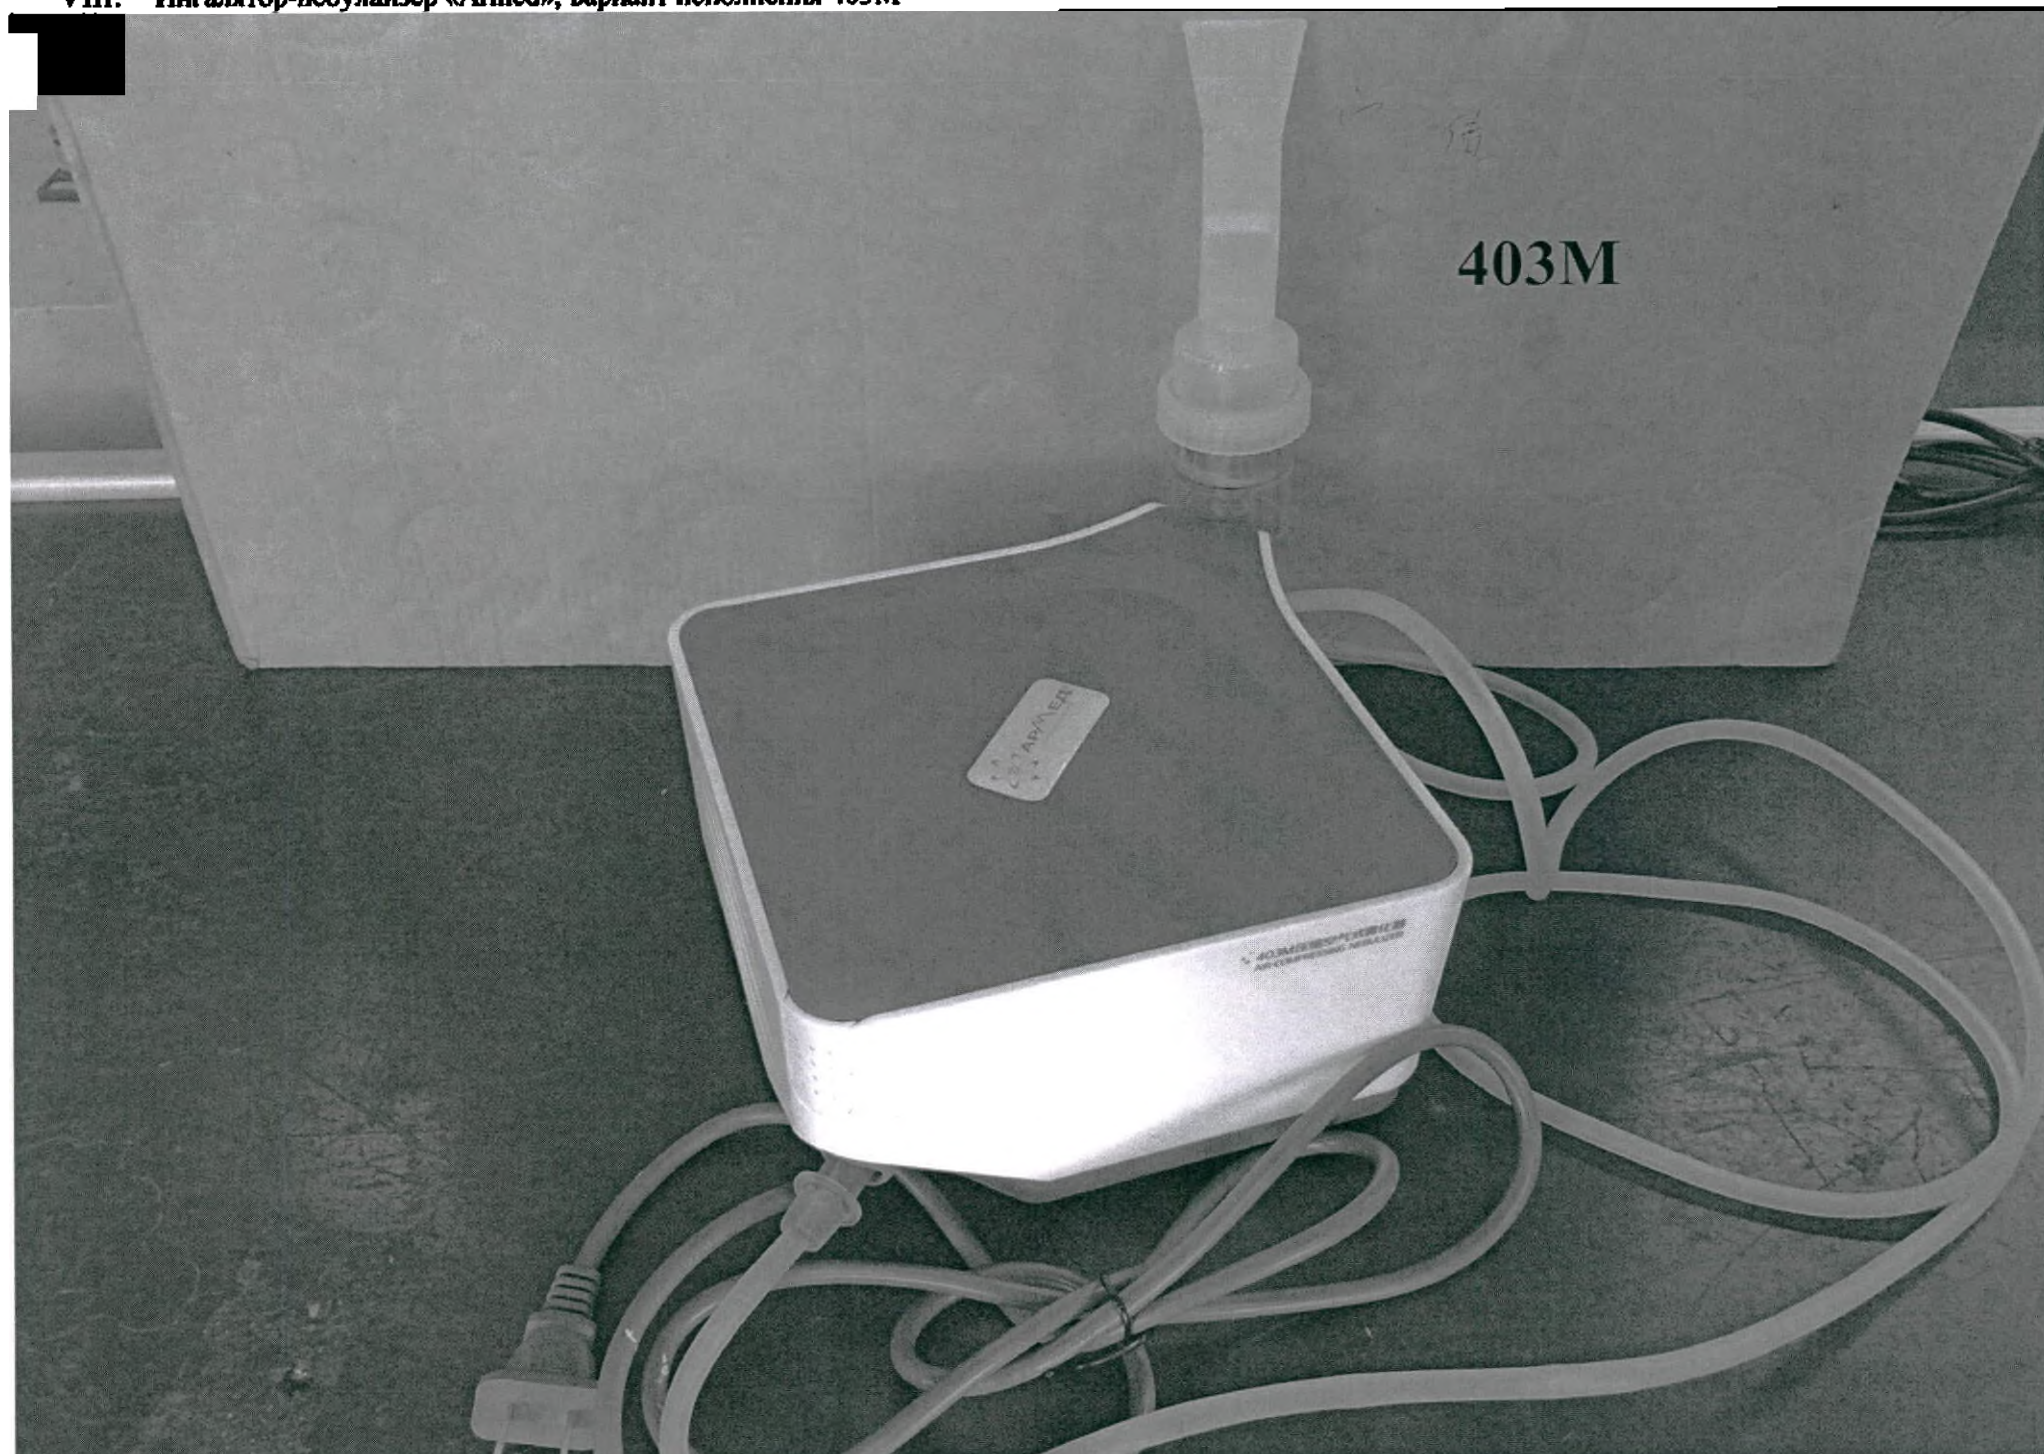


IX. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403T

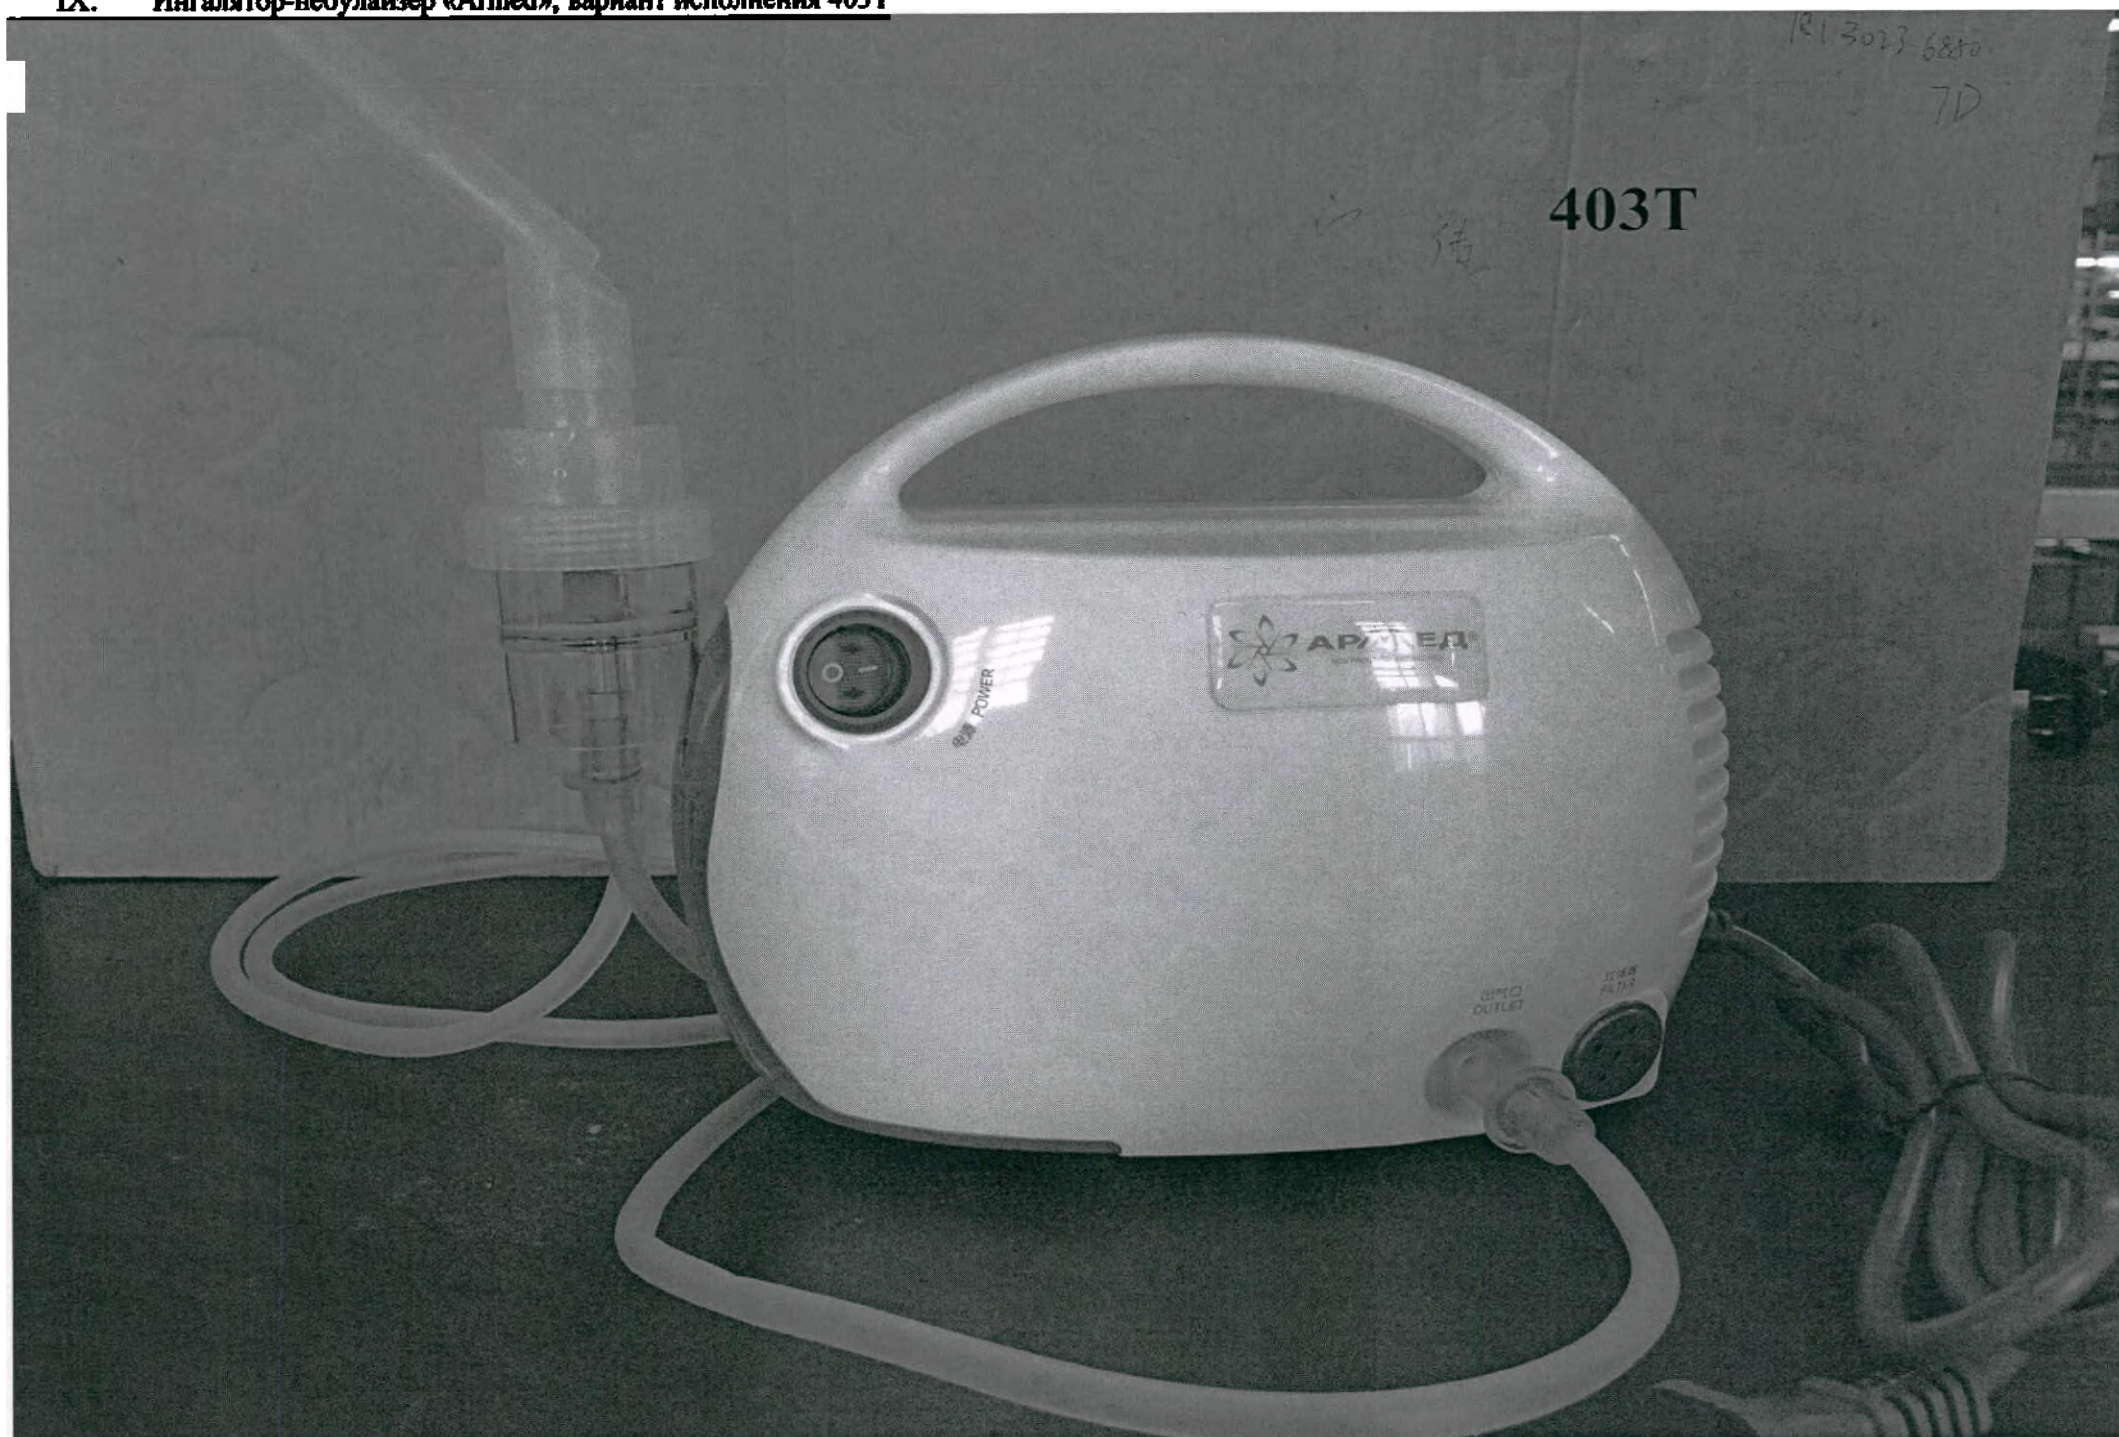


Х. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403K



XI. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405A

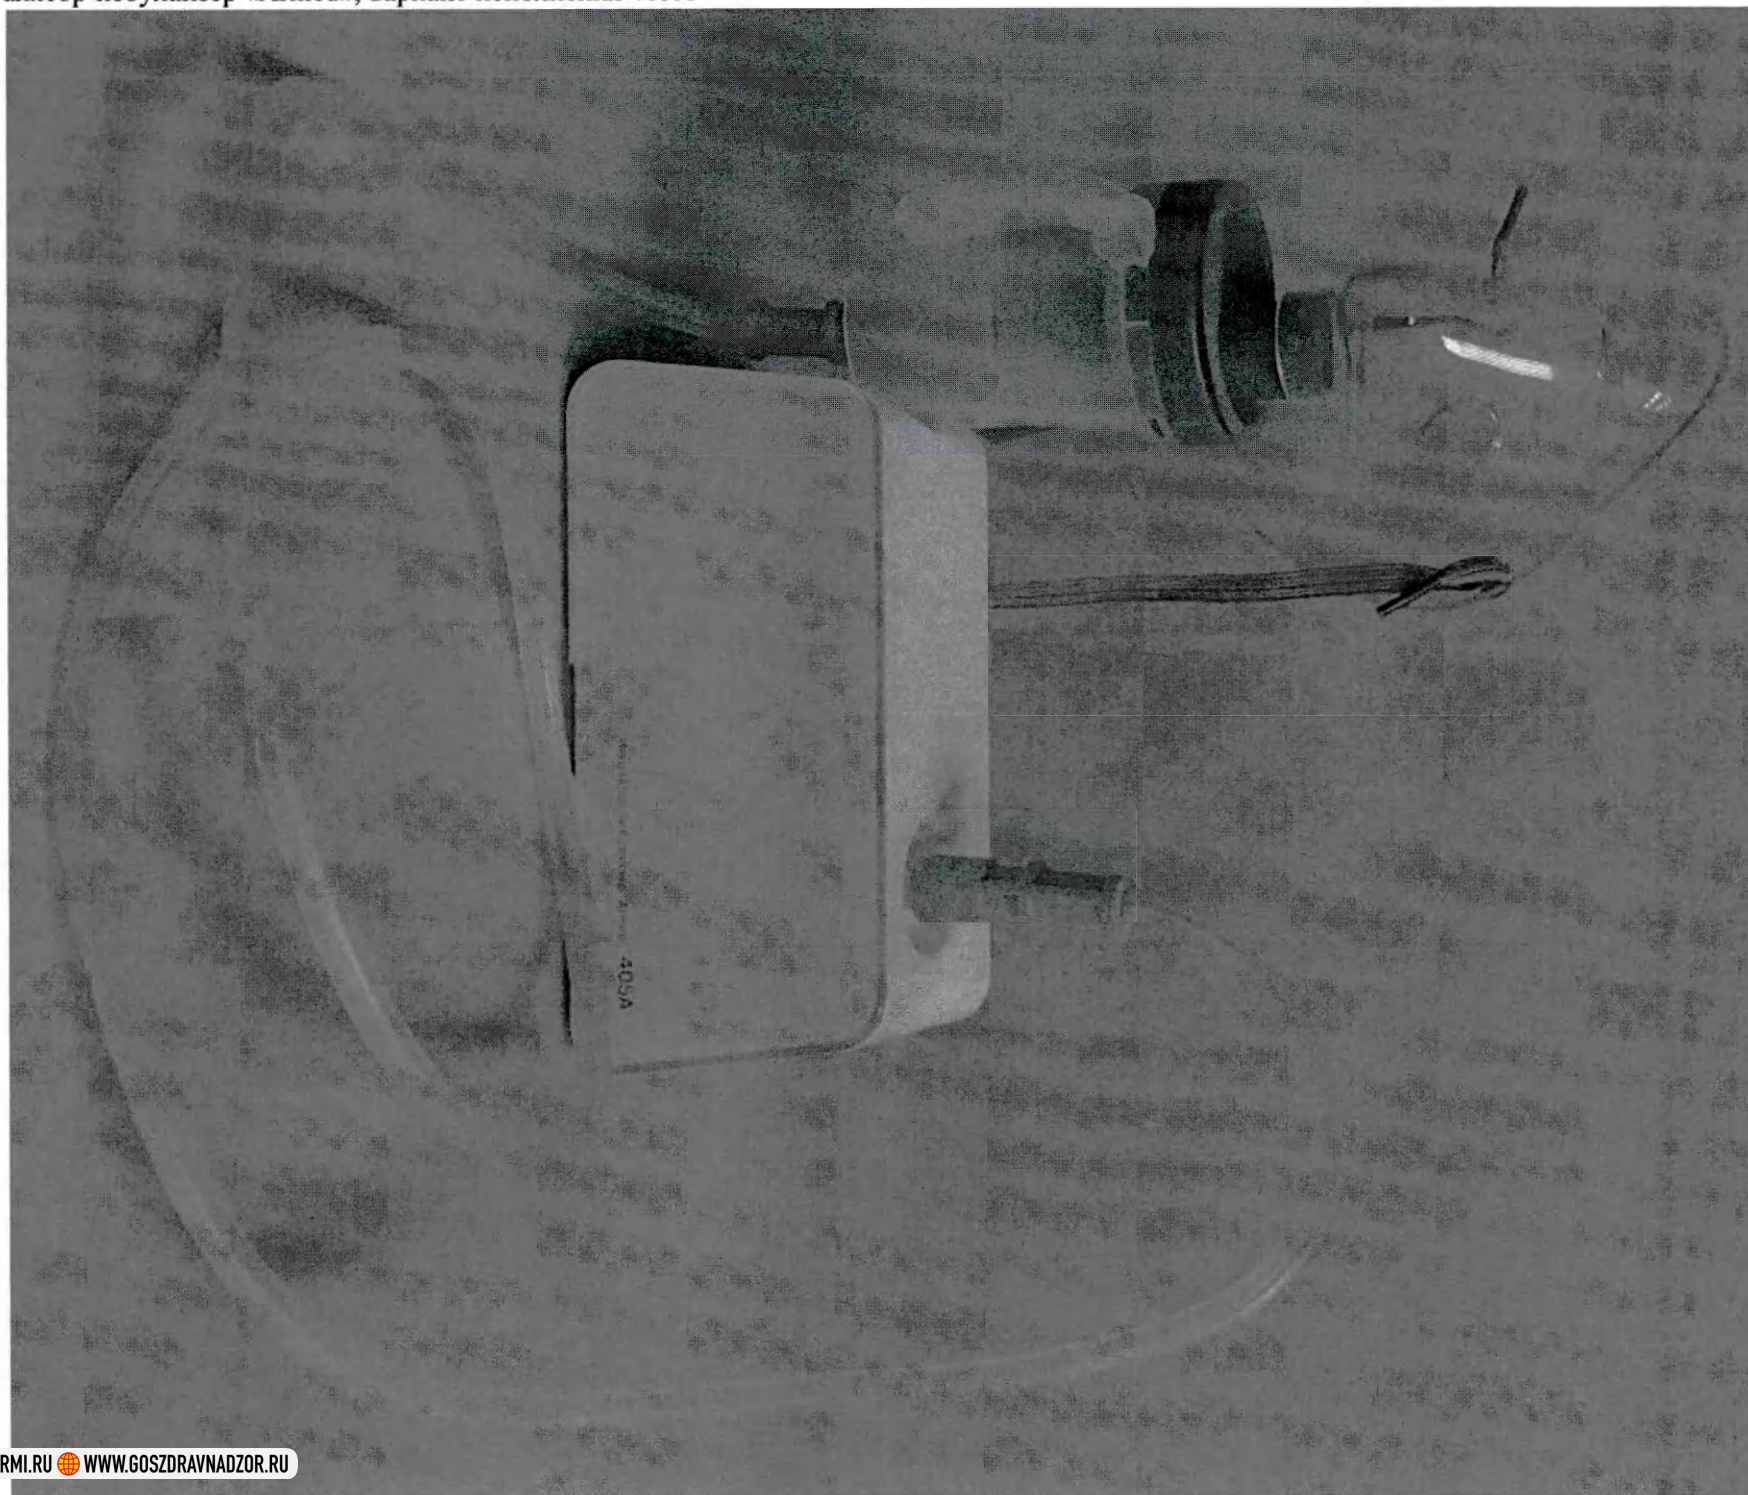


ХП. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405В

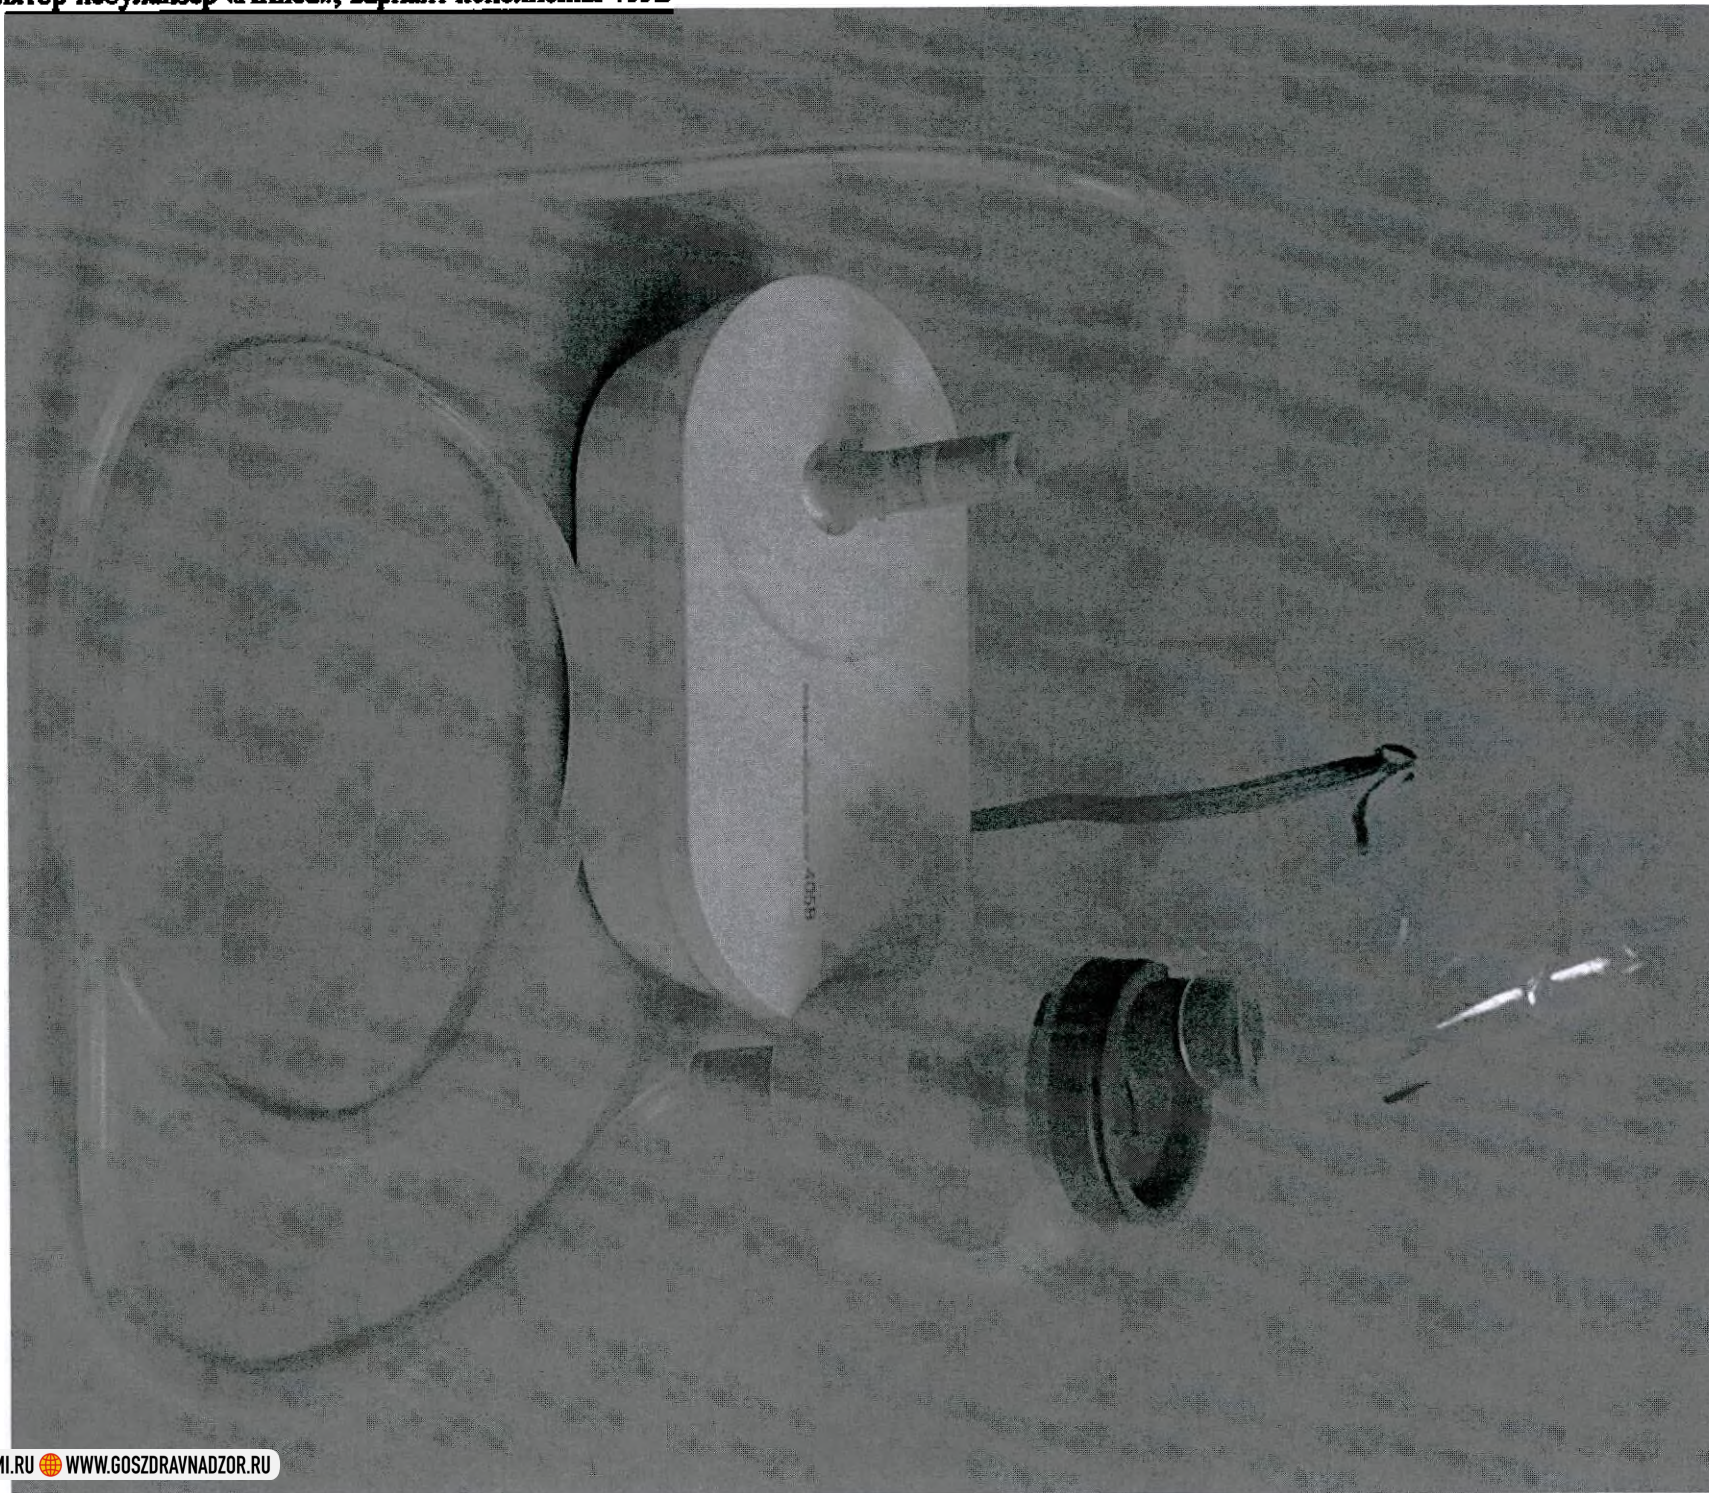

ХІІІ. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 407А



XIV. Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S

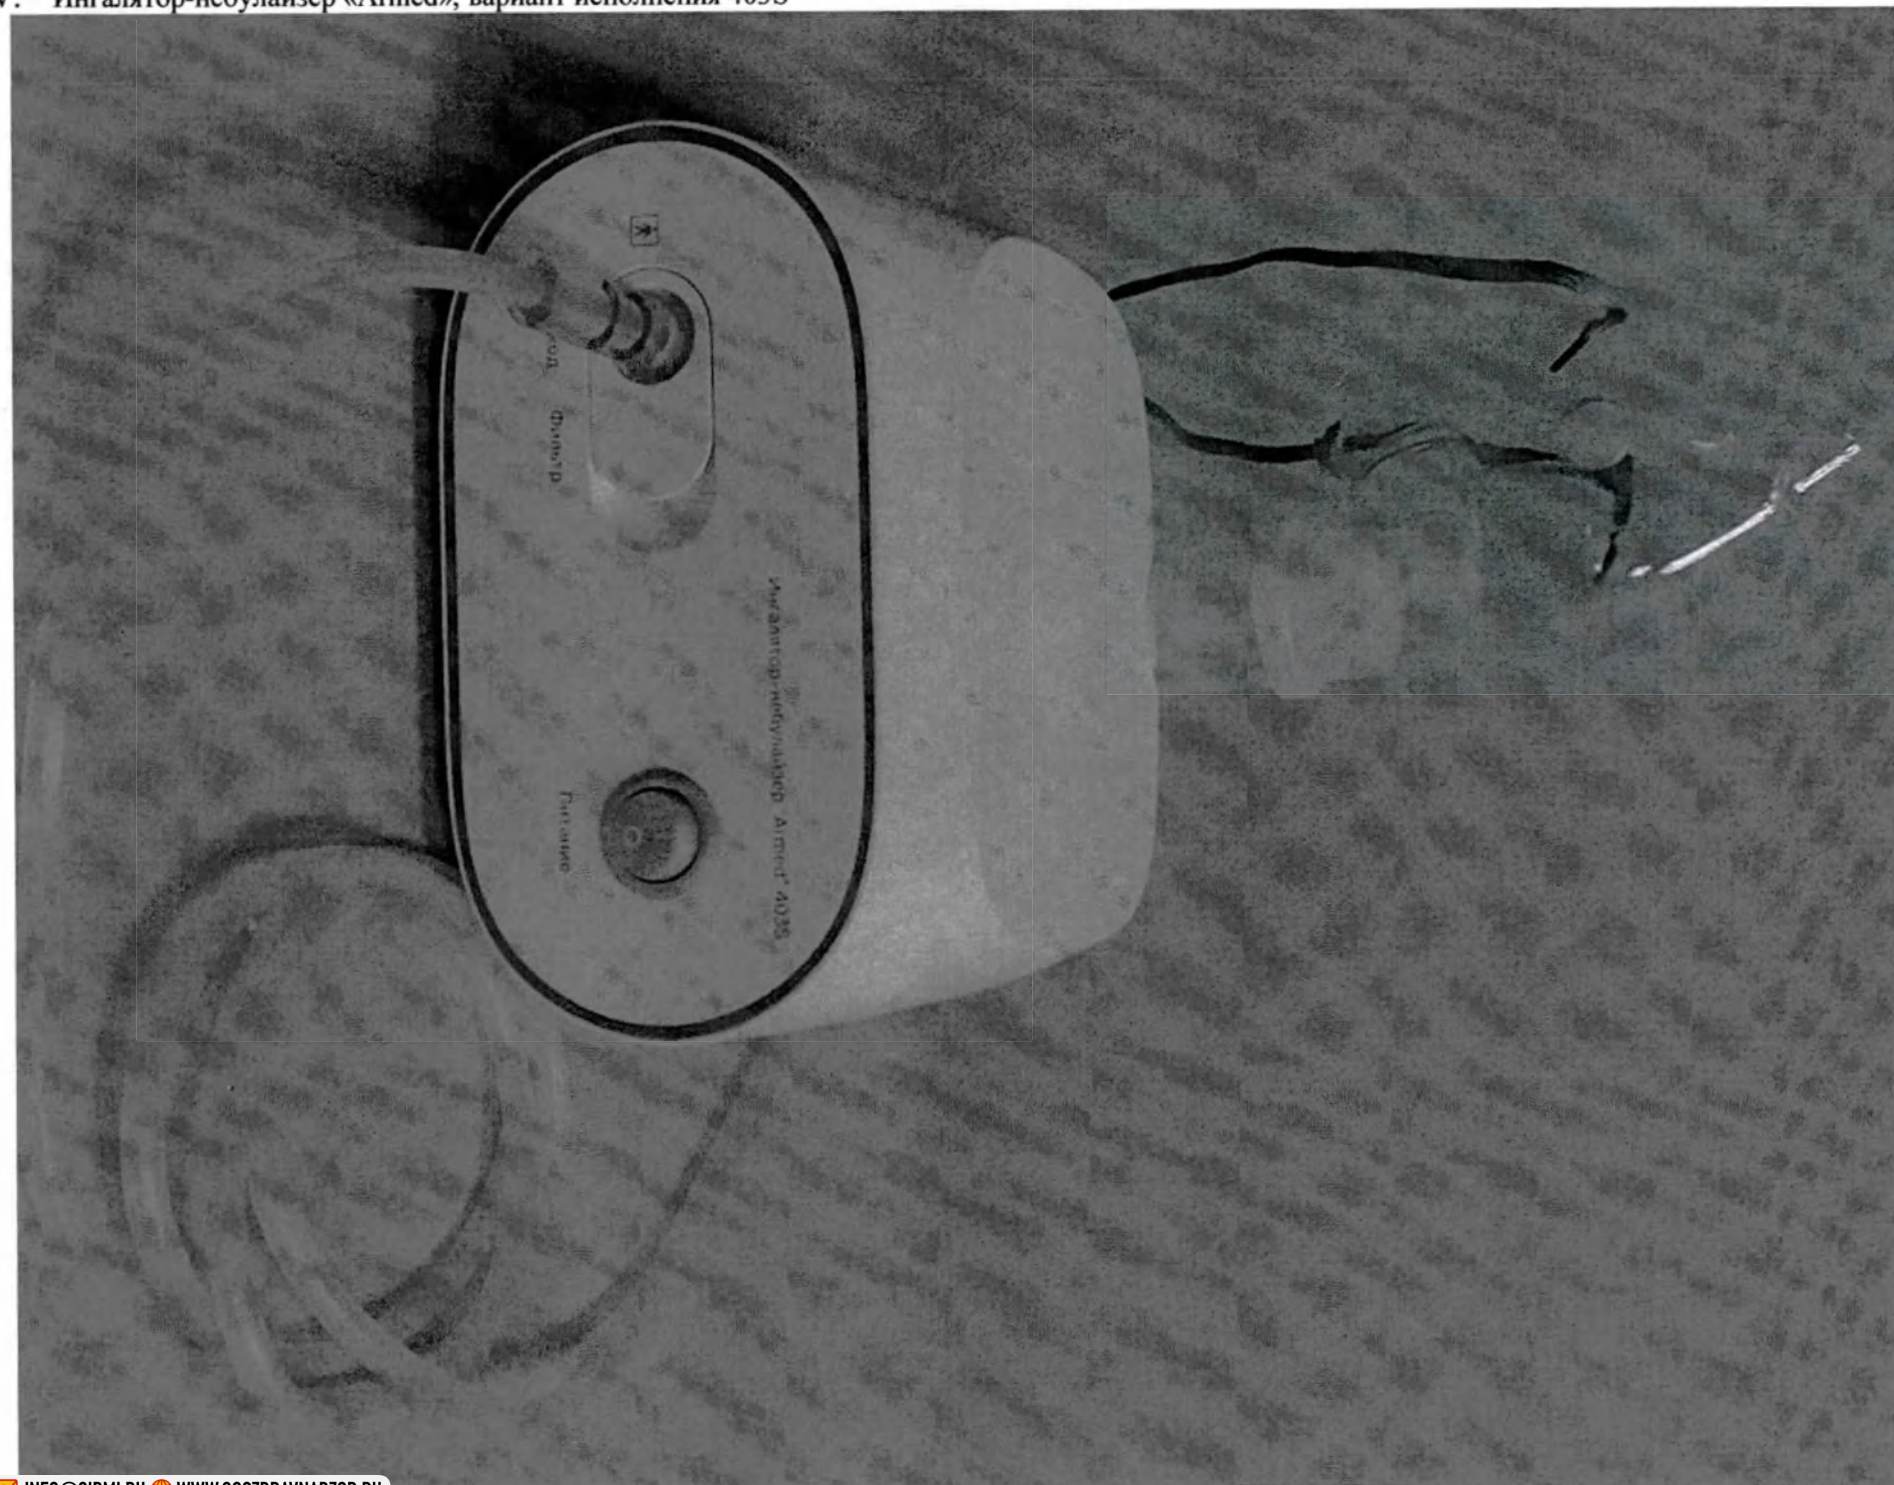

Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403А

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN



Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403В

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN





Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403С

РУ № РЗН _____ от _____ г

SN



Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403AI

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN




Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

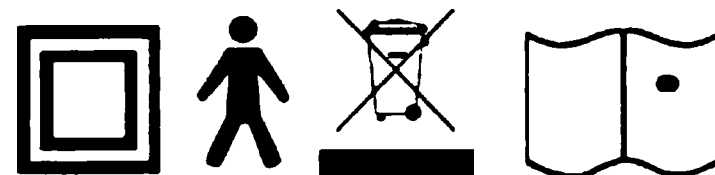

Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403D

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN



Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30


Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403Н

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN





Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403E

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN



Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30


Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403М

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN




Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30


Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403Т

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN



Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30


Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер "Armed": вариант исполнения 403K

РУ № РЗН _____ ОТ _____ Г

SN





Потребляемая мощность, не более: 130 ВА

~ 220±22 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 30/30

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.



Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405A

РУ № РЗН_____ОТ _____

**Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment &
Supply Co., Ltd.**

**Потребляемая мощность, не более: 15 ВА
~ 230±23 В, 50±1 Гц**

Режим работы и паузы, мин: 20/40

SN 405A02301001

 **01.2023**



Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405B

РУ № РЗН_____ОТ _____

Производитель: Jiangsu Yuuyue Medical Equipment &
Supply Co., Ltd.

Потребляемая мощность, не более: 15 ВА

~ 230±23 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: 20/40

SN 405B02301001

 01.2023



**Ингалятор-небулайзер «Armed»,
вариант исполнения 407A**

РУ № РЗН _____ от _____

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

Потребляемая мощность, не более: 210 ВА

– 230±23 В, 50±1 Гц

Режим работы и паузы, мин: непрерывная

SN 407A02301001



01.2023



Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S

РУ № РЗН_____от _____

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment &
Supply Co., Ltd.

Потребляемая мощность, не более: 220 ВА


~ 230±23 В, 50±1 Гц


Режим работы и паузы, мин: 30/30

SN 403S02301001




01.2023



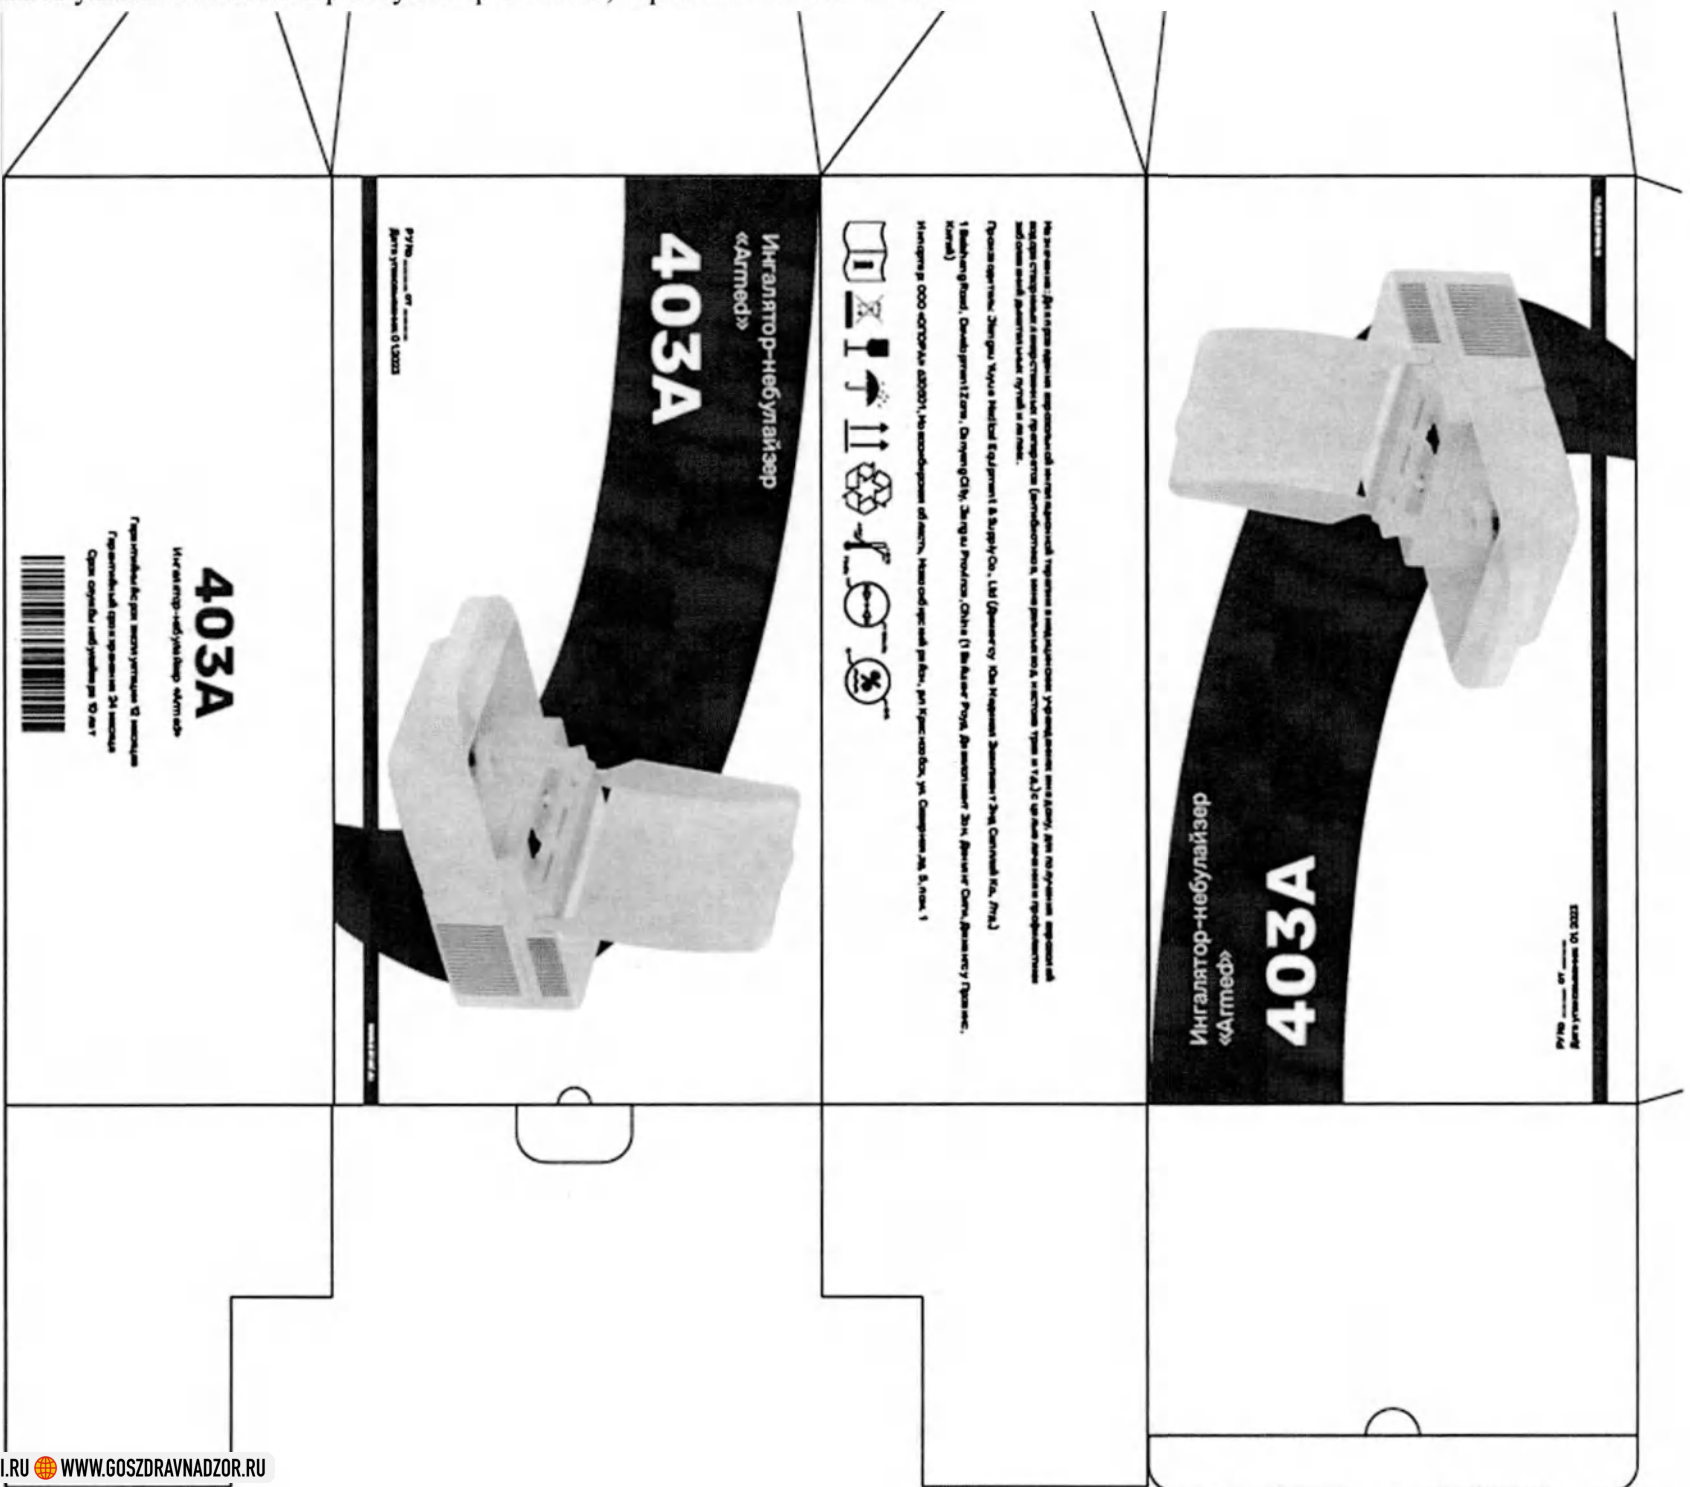


XXX.

Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403В

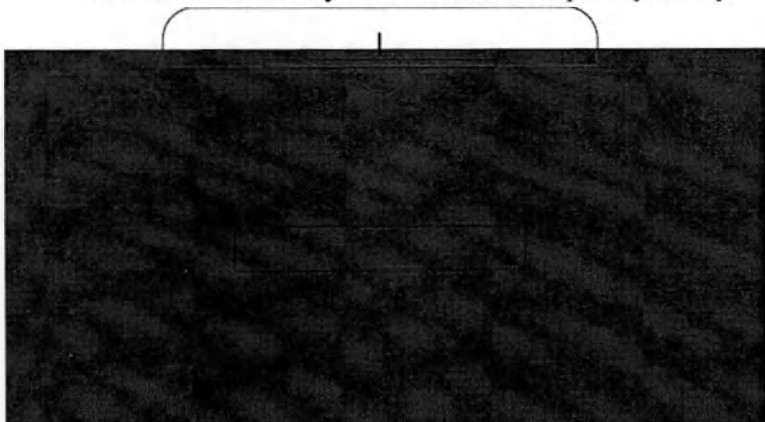

403B

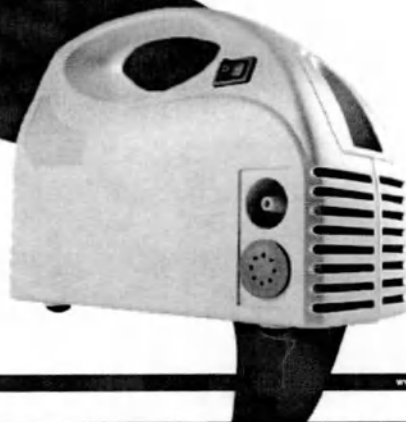

Р/У № _____ ОТ _____
Дата учета недвижимости: 01.2023

were denied re-

403B

Ингалятор-небулайзер «Armed»


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Гарантийный срок хранения 24 месяца

Срок службы небулайзера 10 лет



403B

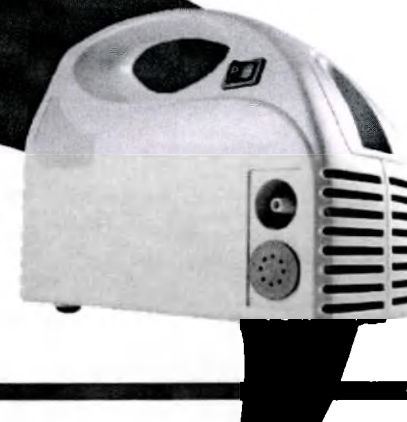


Р/У № _____ от _____
Дата утраты: 01.2023


Назначение: Для проведения ингаляционной ингаляционной терапии в медицинских учреждениях и на дому, для получения аэрозольных водорастворимых лекарственных препаратов (антибиотиков, минеральных вод, настоев трав и т.д.) с целью лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких.


Производитель: Jiangsu Yuue Medical Equipment & Supply Co., Ltd (Джянгсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.)


1Baisheng Road, Development Zone, Danyang City,
Jiangsu Province, China (1 Байшэн Роуд, Девелопмент
Зон, Даньянг Сити, Дзянсу Провинс, Китай)


Импортер: ООО «ОПОРА» 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р/л Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1



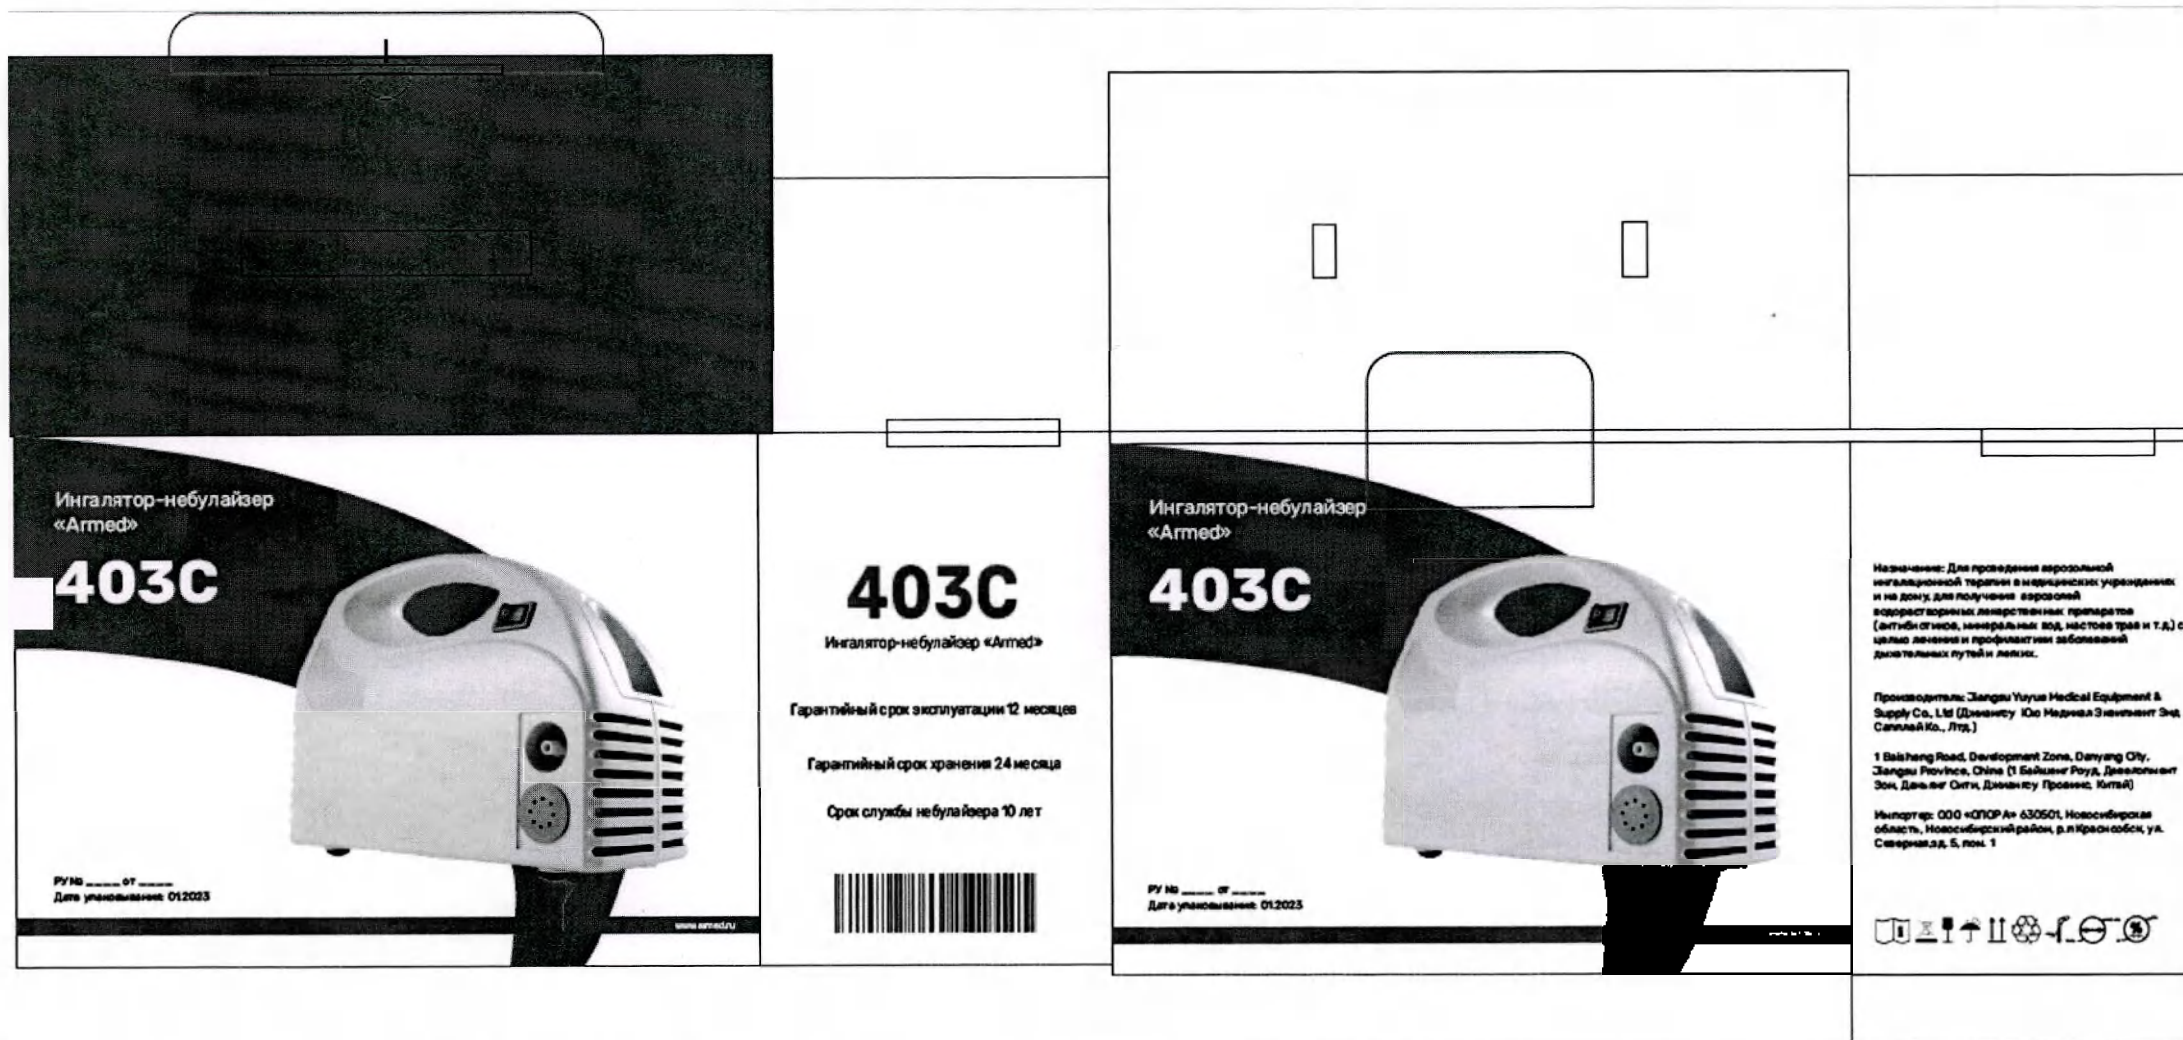


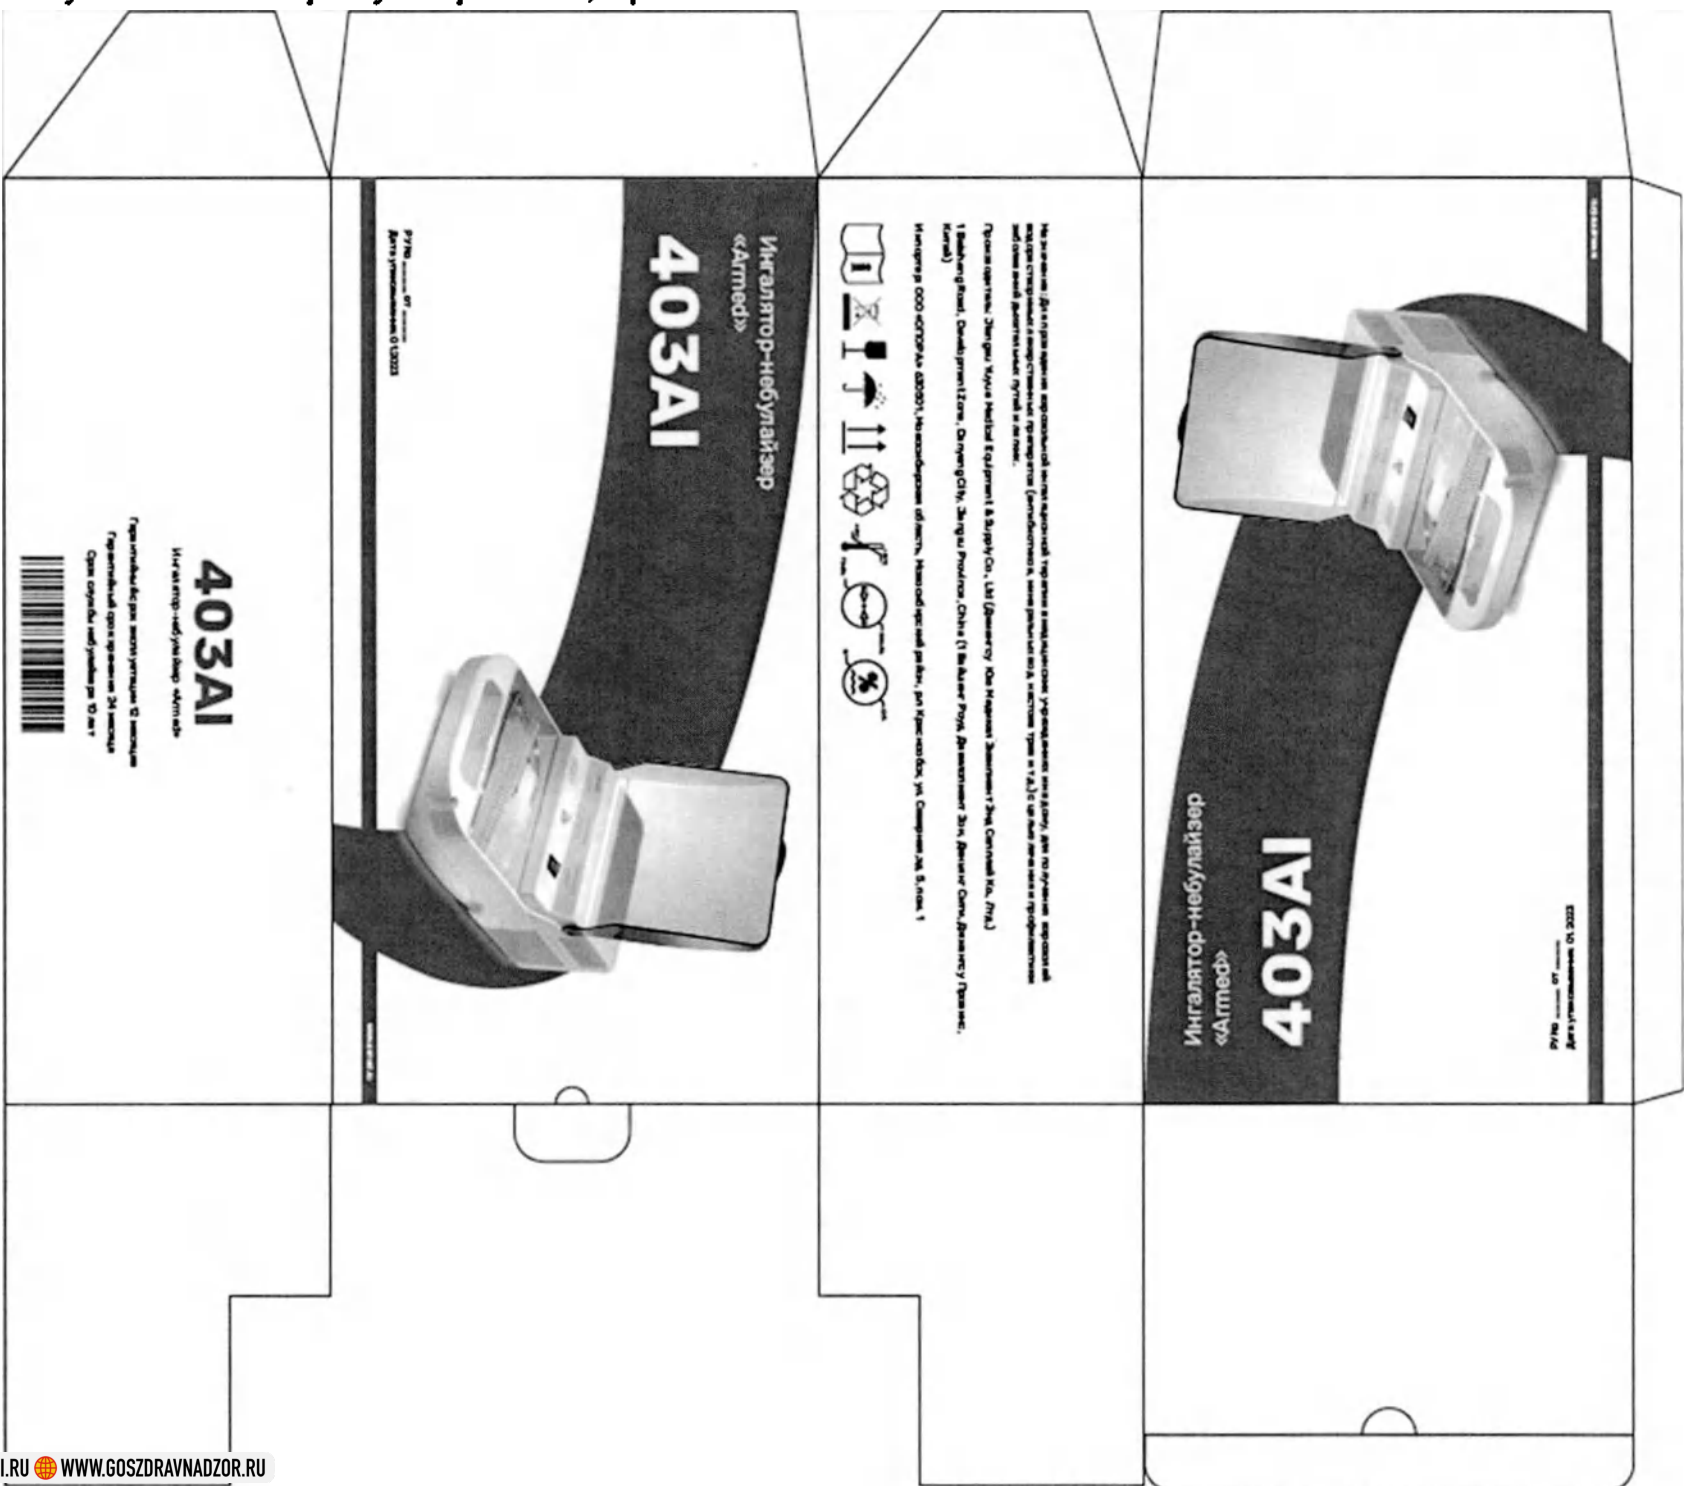

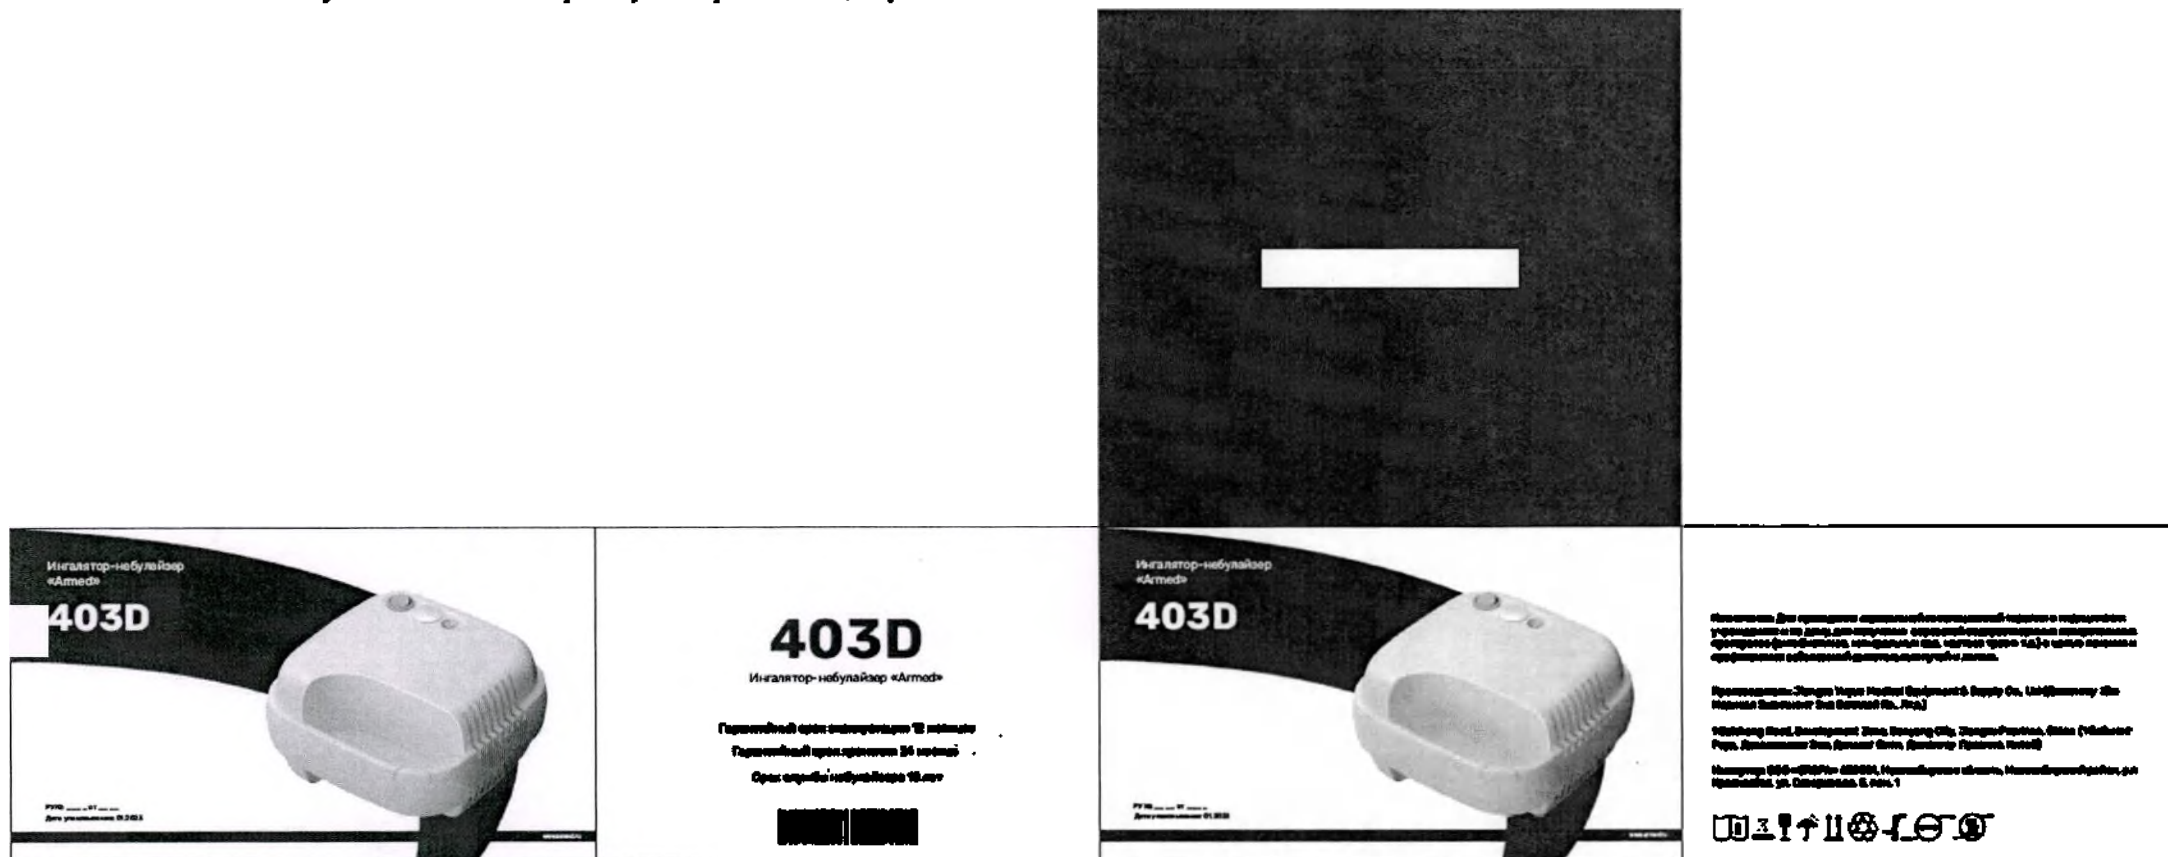

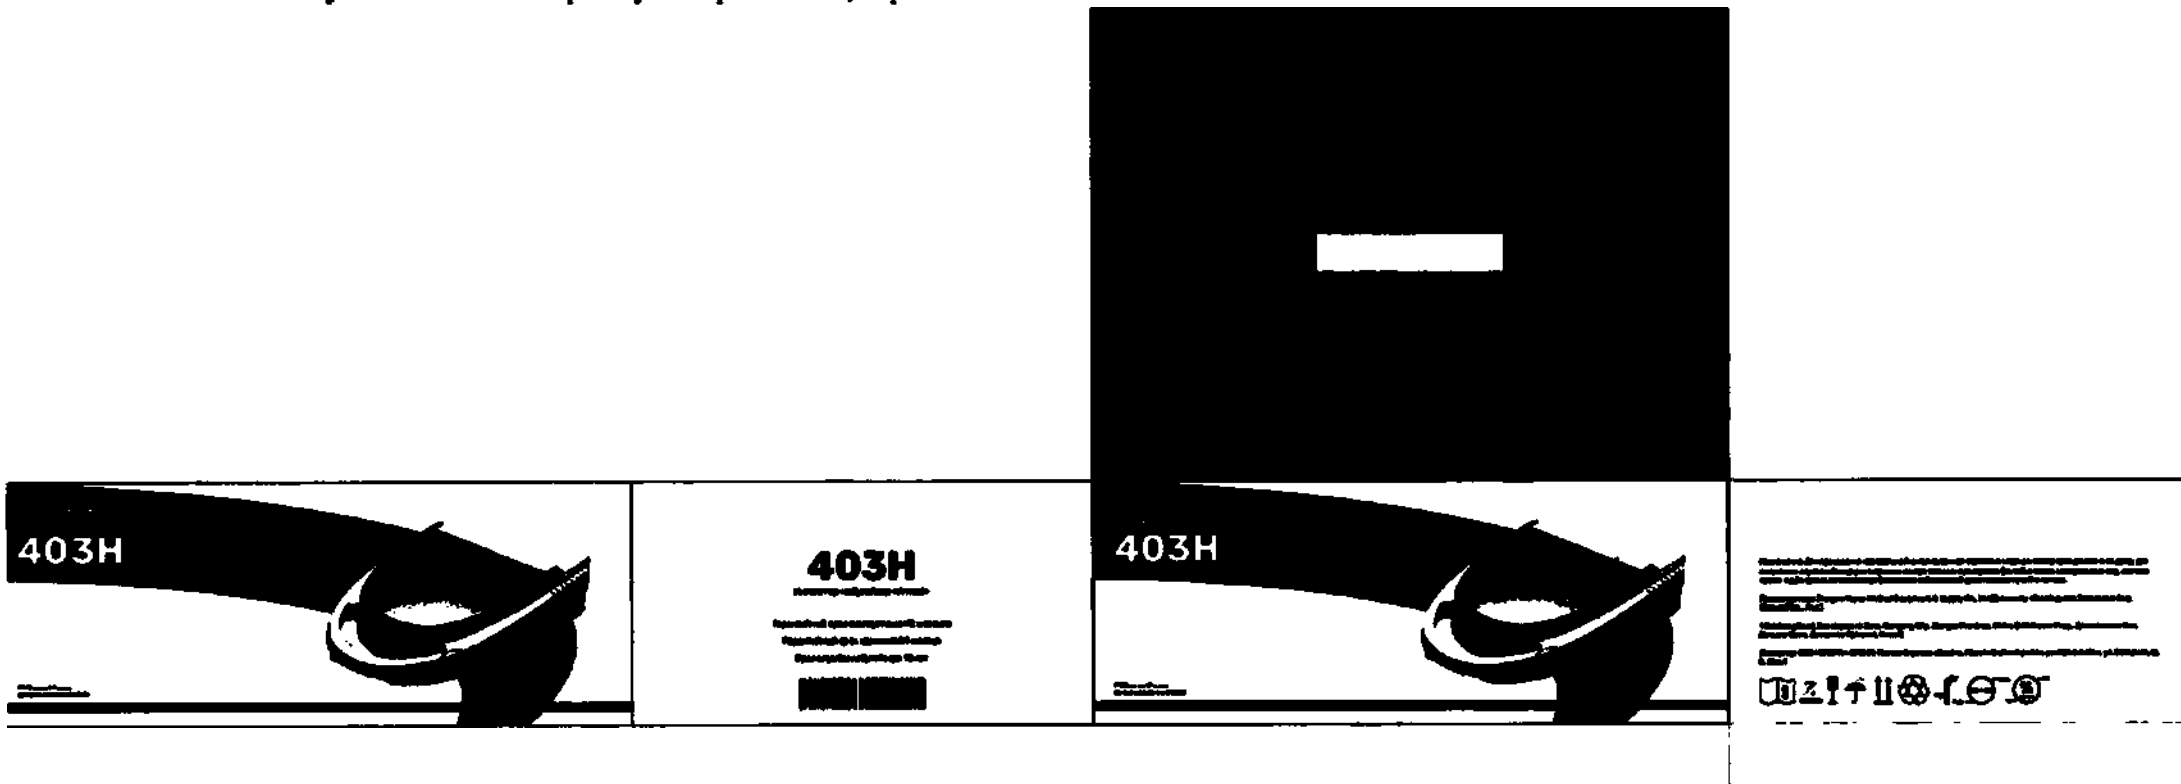



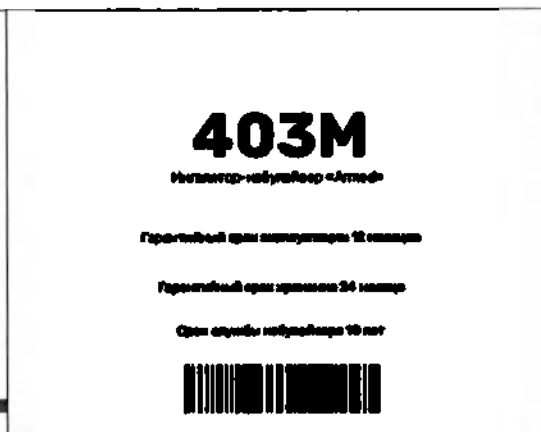

Надгробники для преставления усопших в усыпальничном гробнице в монастырском кладбищенском здании, расположенном в центре территории, являются архитектурными элементами, подчеркивающими статус и значение кладбища. Надгробники выполнены из камня и имеют различные формы, размеры и украшения. Надгробники для мужчин обычно имеют более высокие и массивные формы, а для женщин – более низкие и изящные. Надгробники для детей имеют более простые и компактные формы. Надгробники для священников имеют более высокие и массивные формы, а для монахов – более низкие и изящные. Надгробники для монахинь имеют более простые и компактные формы. Надгробники для детей имеют более простые и компактные формы. Надгробники для священников имеют более высокие и массивные формы, а для монахов – более низкие и изящные. Надгробники для монахинь имеют более простые и компактные формы.

Representative: Zhongguo Wuyue (Industrial Equipment & Supply Co., Ltd (formerly The Shanghai Instrument & Equipment Co., Ltd.)


¹ Shishang Road, Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province, China (160km from Yangzhou City, Jiangsu Province, China, Nanjing City Postcode: 210000)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110







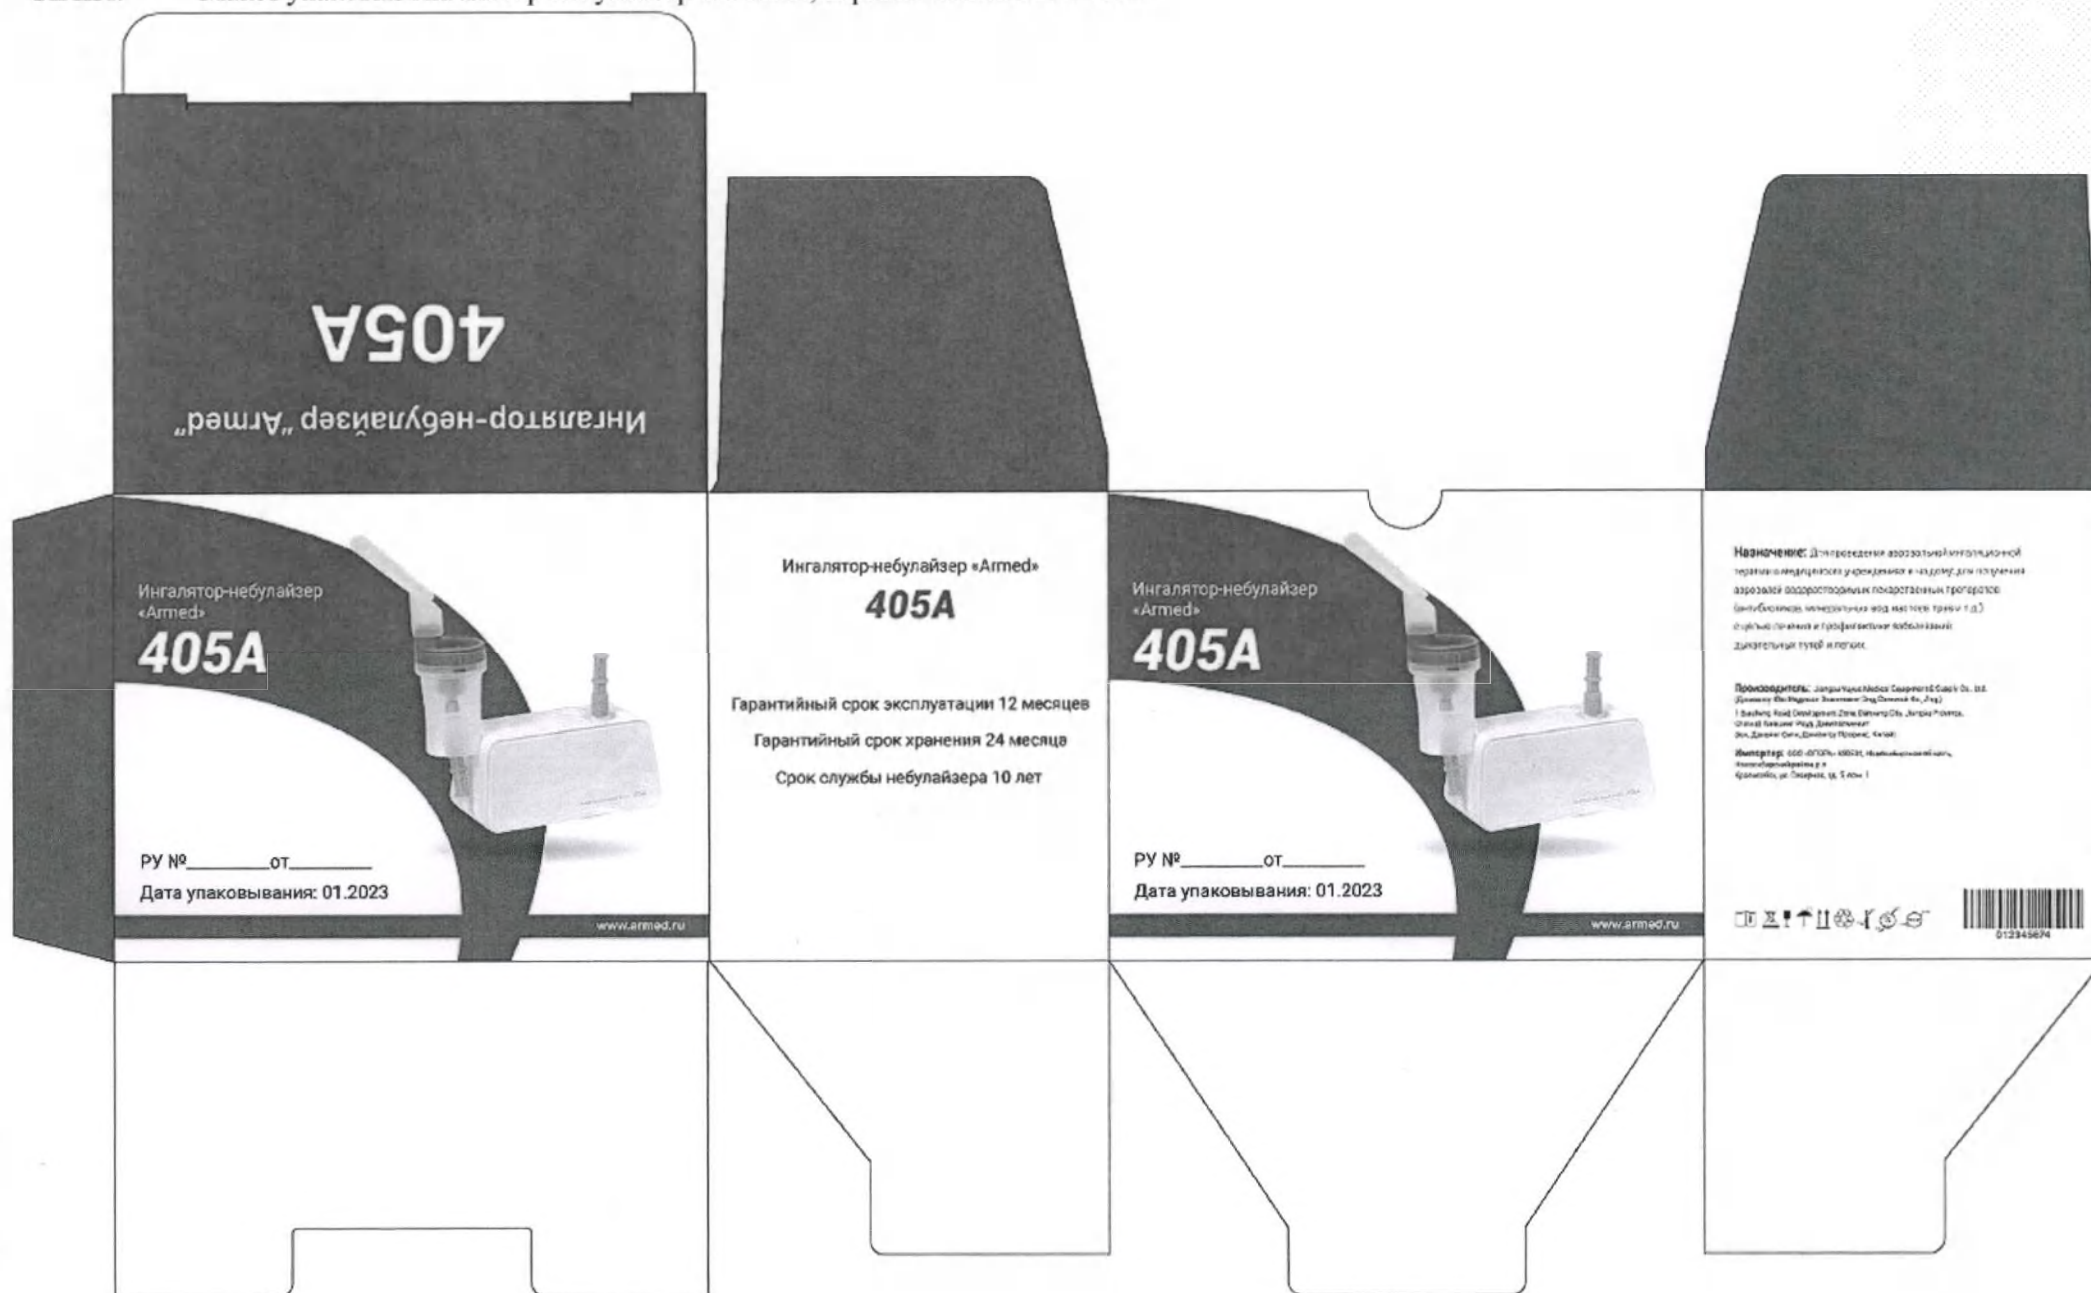

XL. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 405B



XLI. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 407A



XLII. Макет упаковки Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403S



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(срок шифра)

