


Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq, с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента Регистрации
и Сертификации, Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А.П. Харитонов

«24» апреля 2024 г.



Системный блок.



Системный блок.



Системный блок.



Системный блок.



Монитор.



Vivid iq



SN 6105102WX0



2020-10-10

22B $\approx$ 6.8A

CISPR 11 / EN55011

Класс: A Группа: 1



GE Medical Systems (China) Co., Ltd.

No.19, Changjiang Road, Wuxi, National Hi-Tech
Development Zone Jiangsu, P.R.China 214028

Сделано в Китае

EAC



**R ONLY
U.S.**




CISPR 11 / EN 55011
CLASS : A GROUP : 1
CLASSE : A GROUPE : 1

CE 0197

Кабель электропитания.



Руководство пользователя на русском языке.

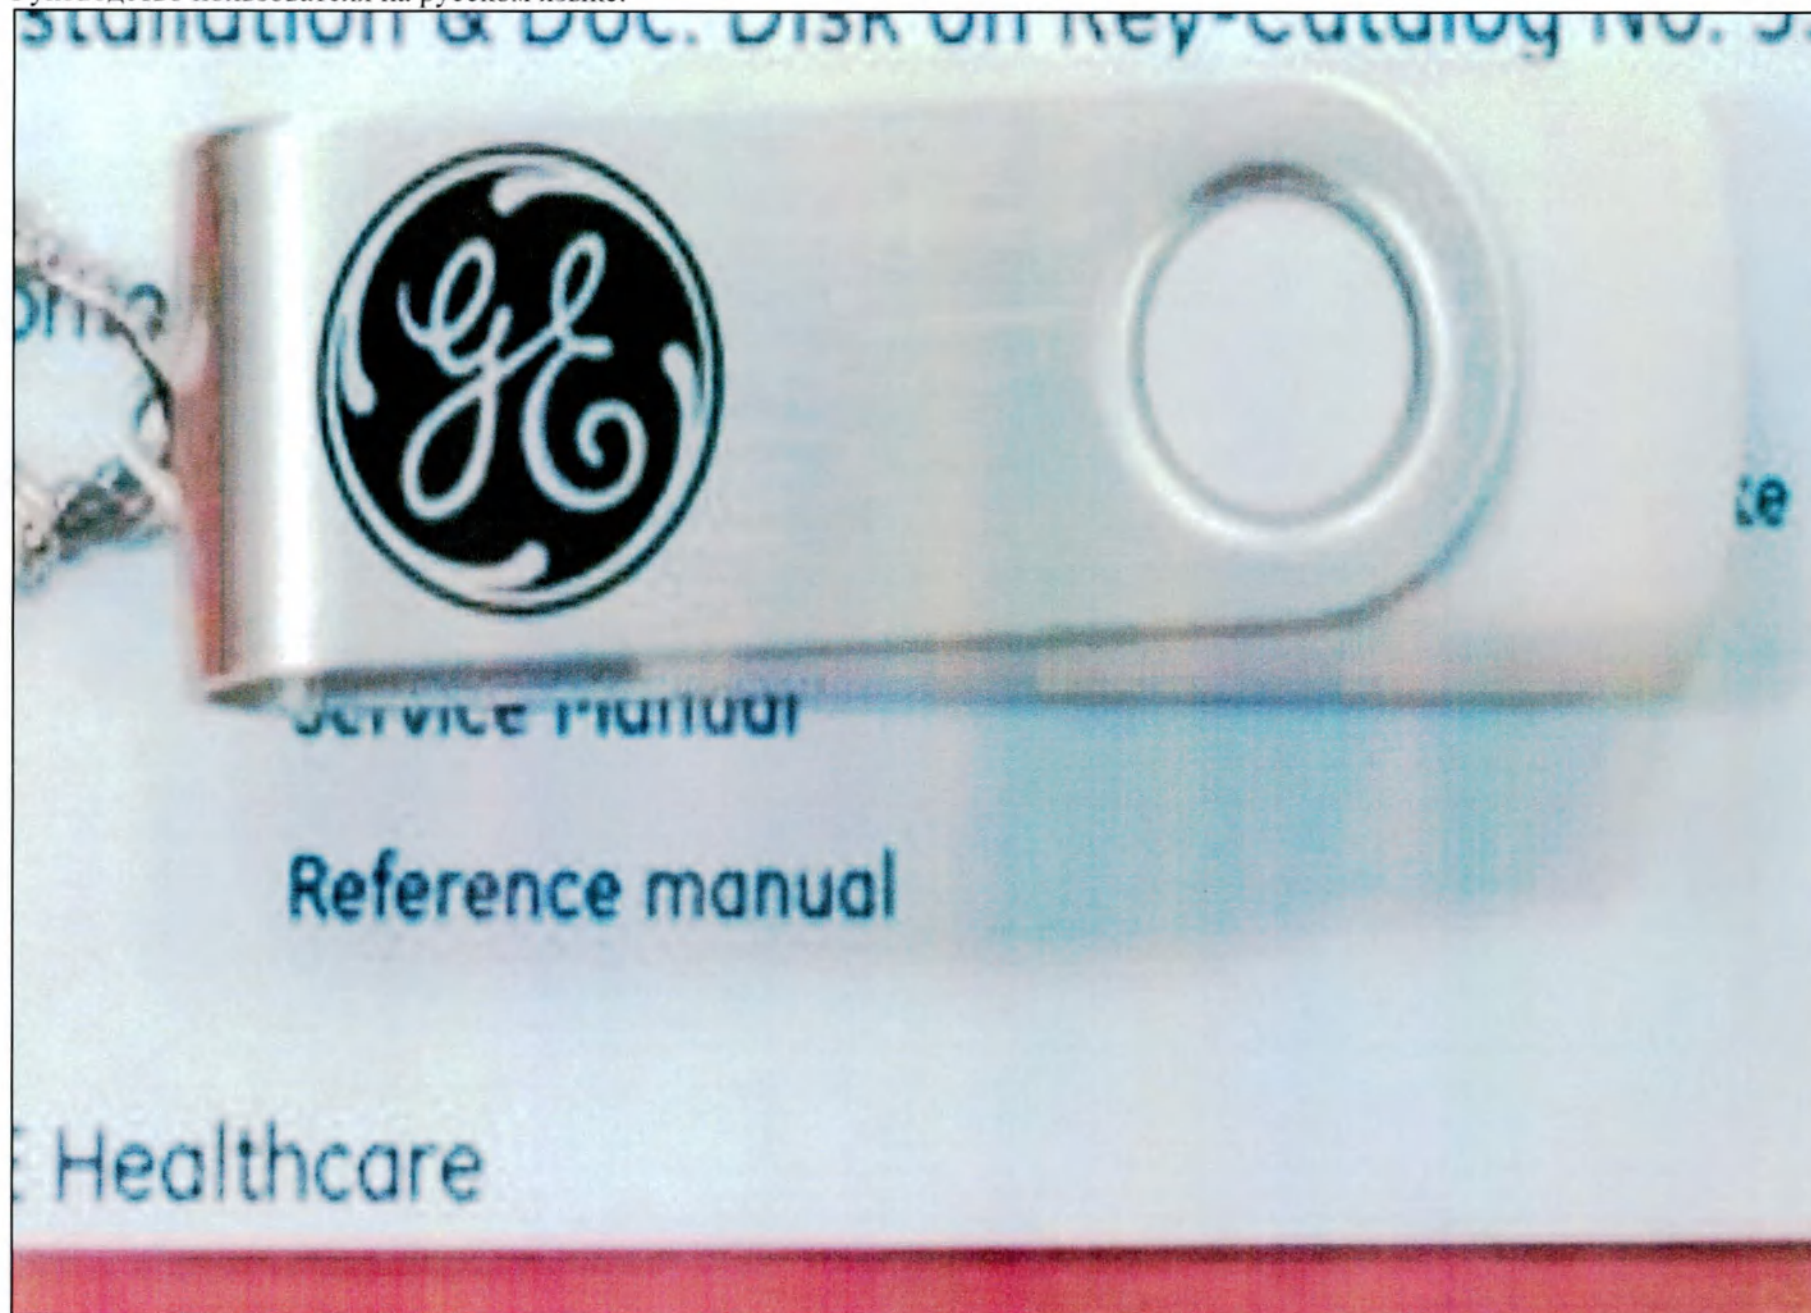


Программное обеспечение Vivid iq на оптическом или электронном носителе.




Датчик секторный фазированный 3Sc-RS.



Датчик секторный фазированный 6S-RS.

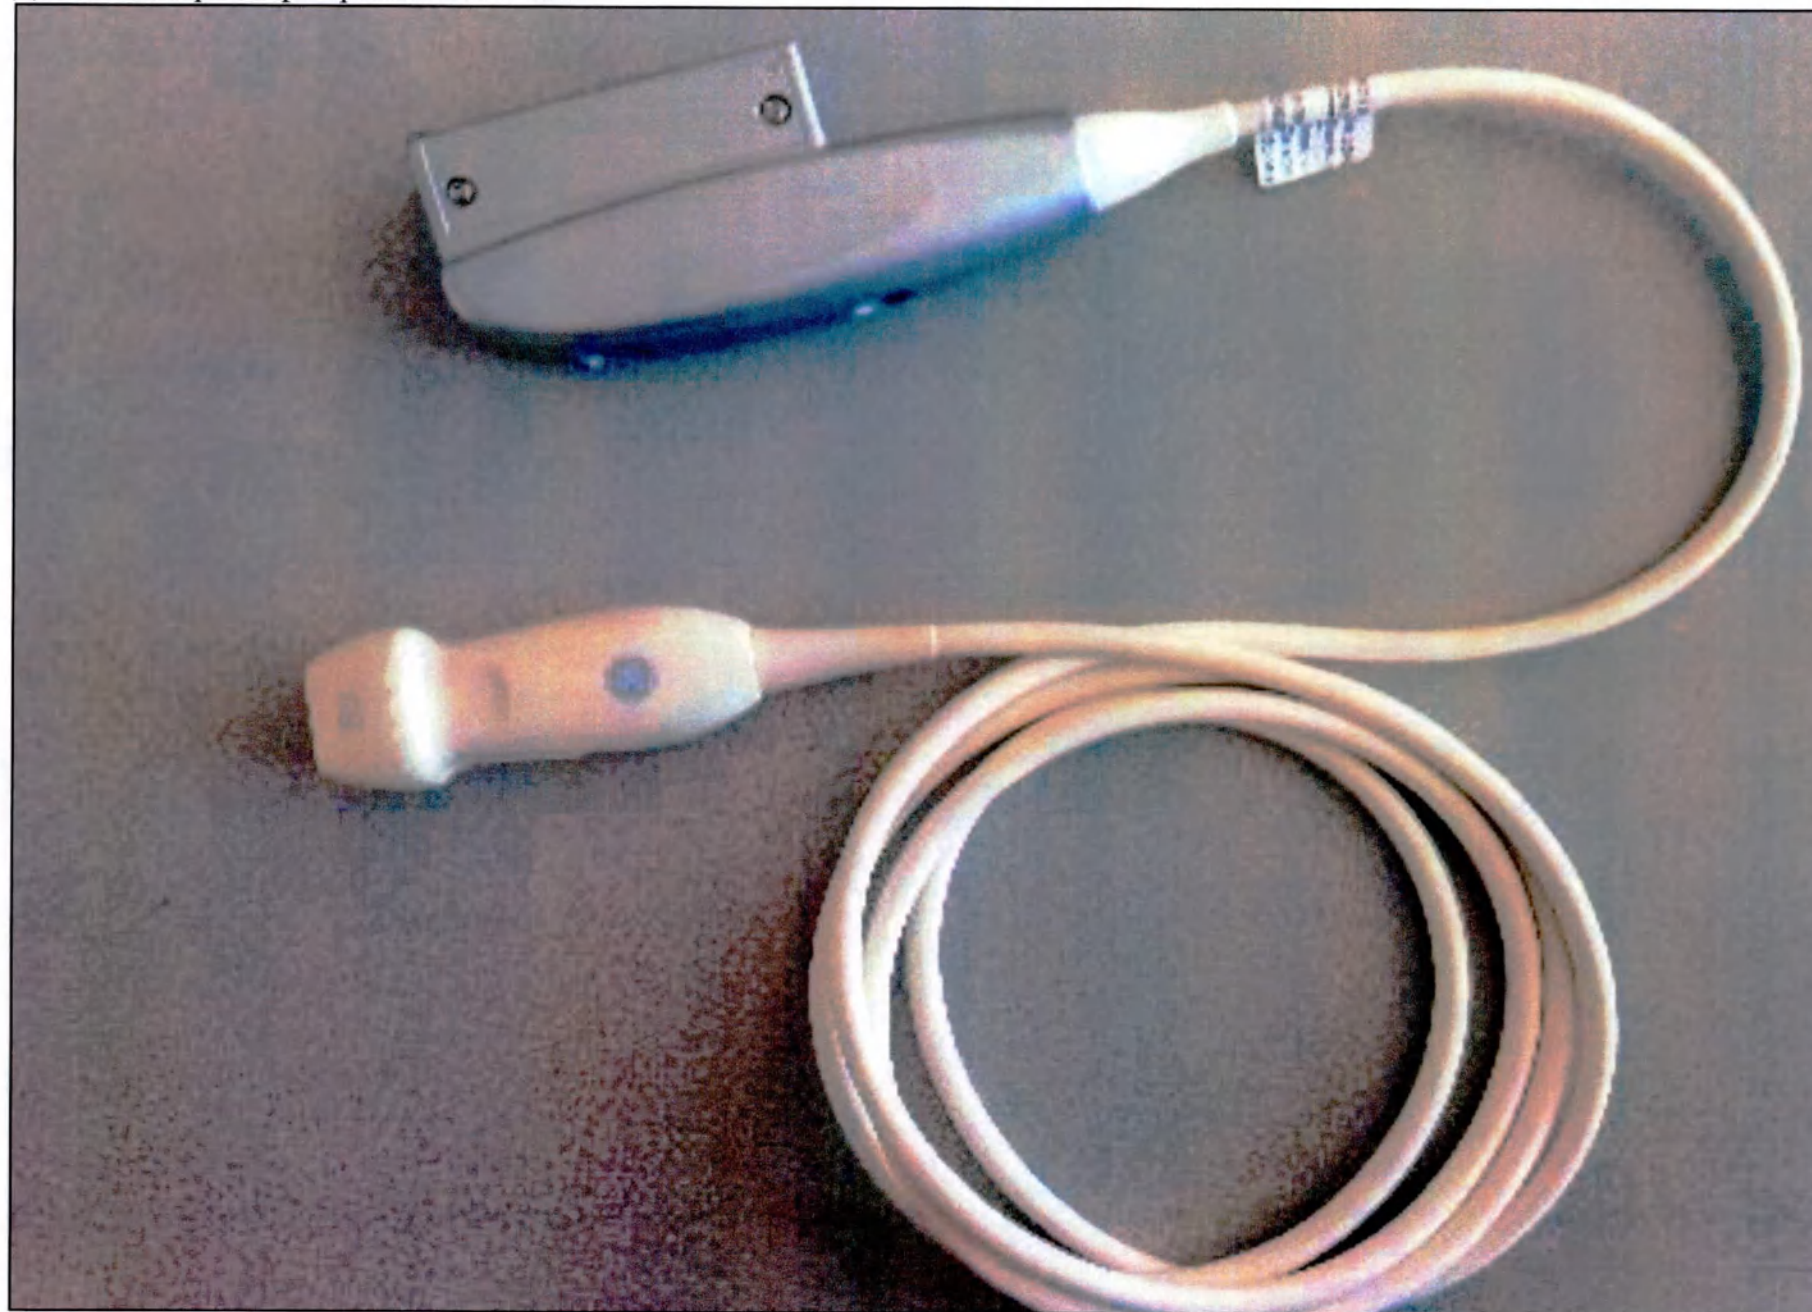


Датчик секторный фазированный 12S-RS.

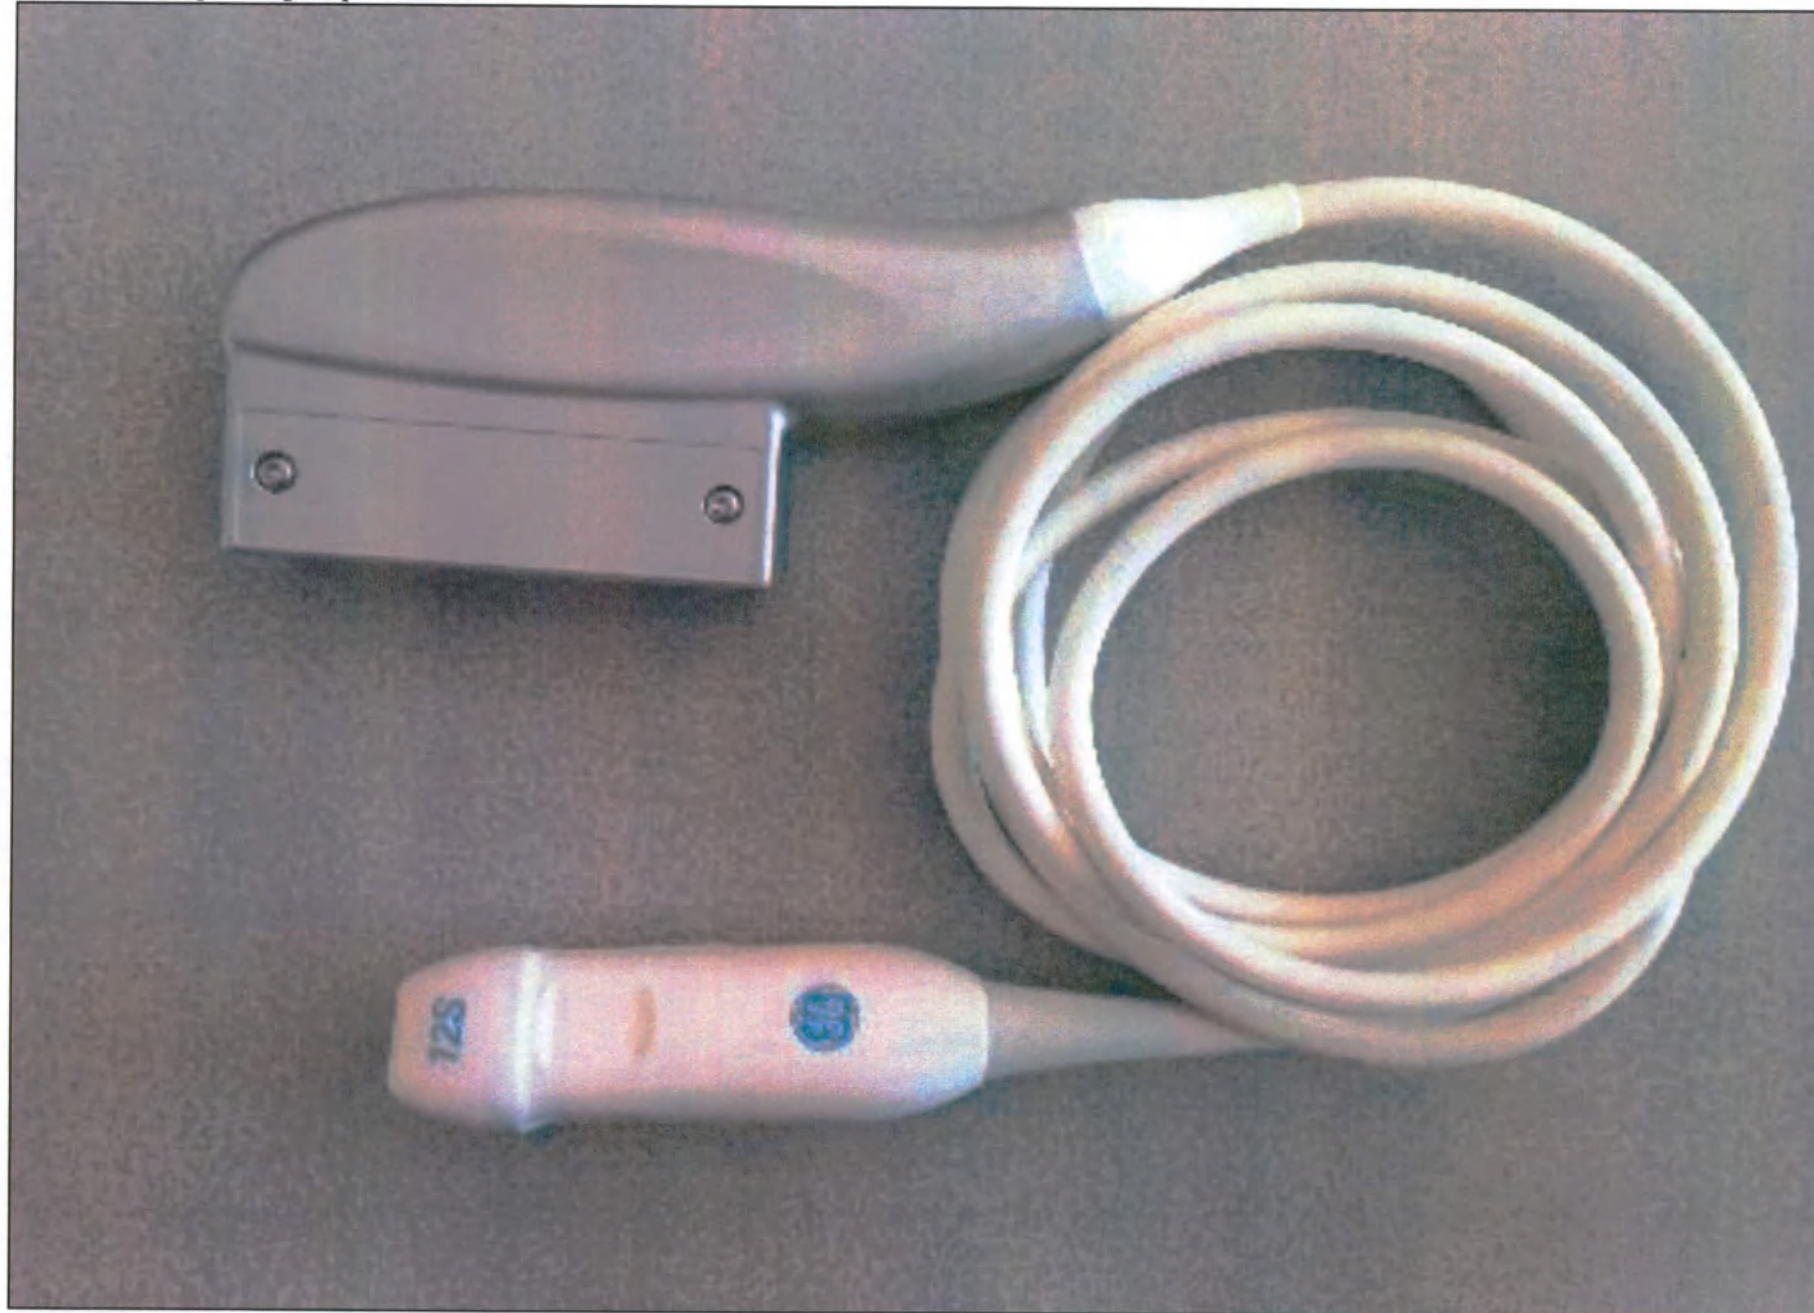

Датчик секторный фазированный матричный M5Sc-RS.




Датчик линейный 9L-RS.

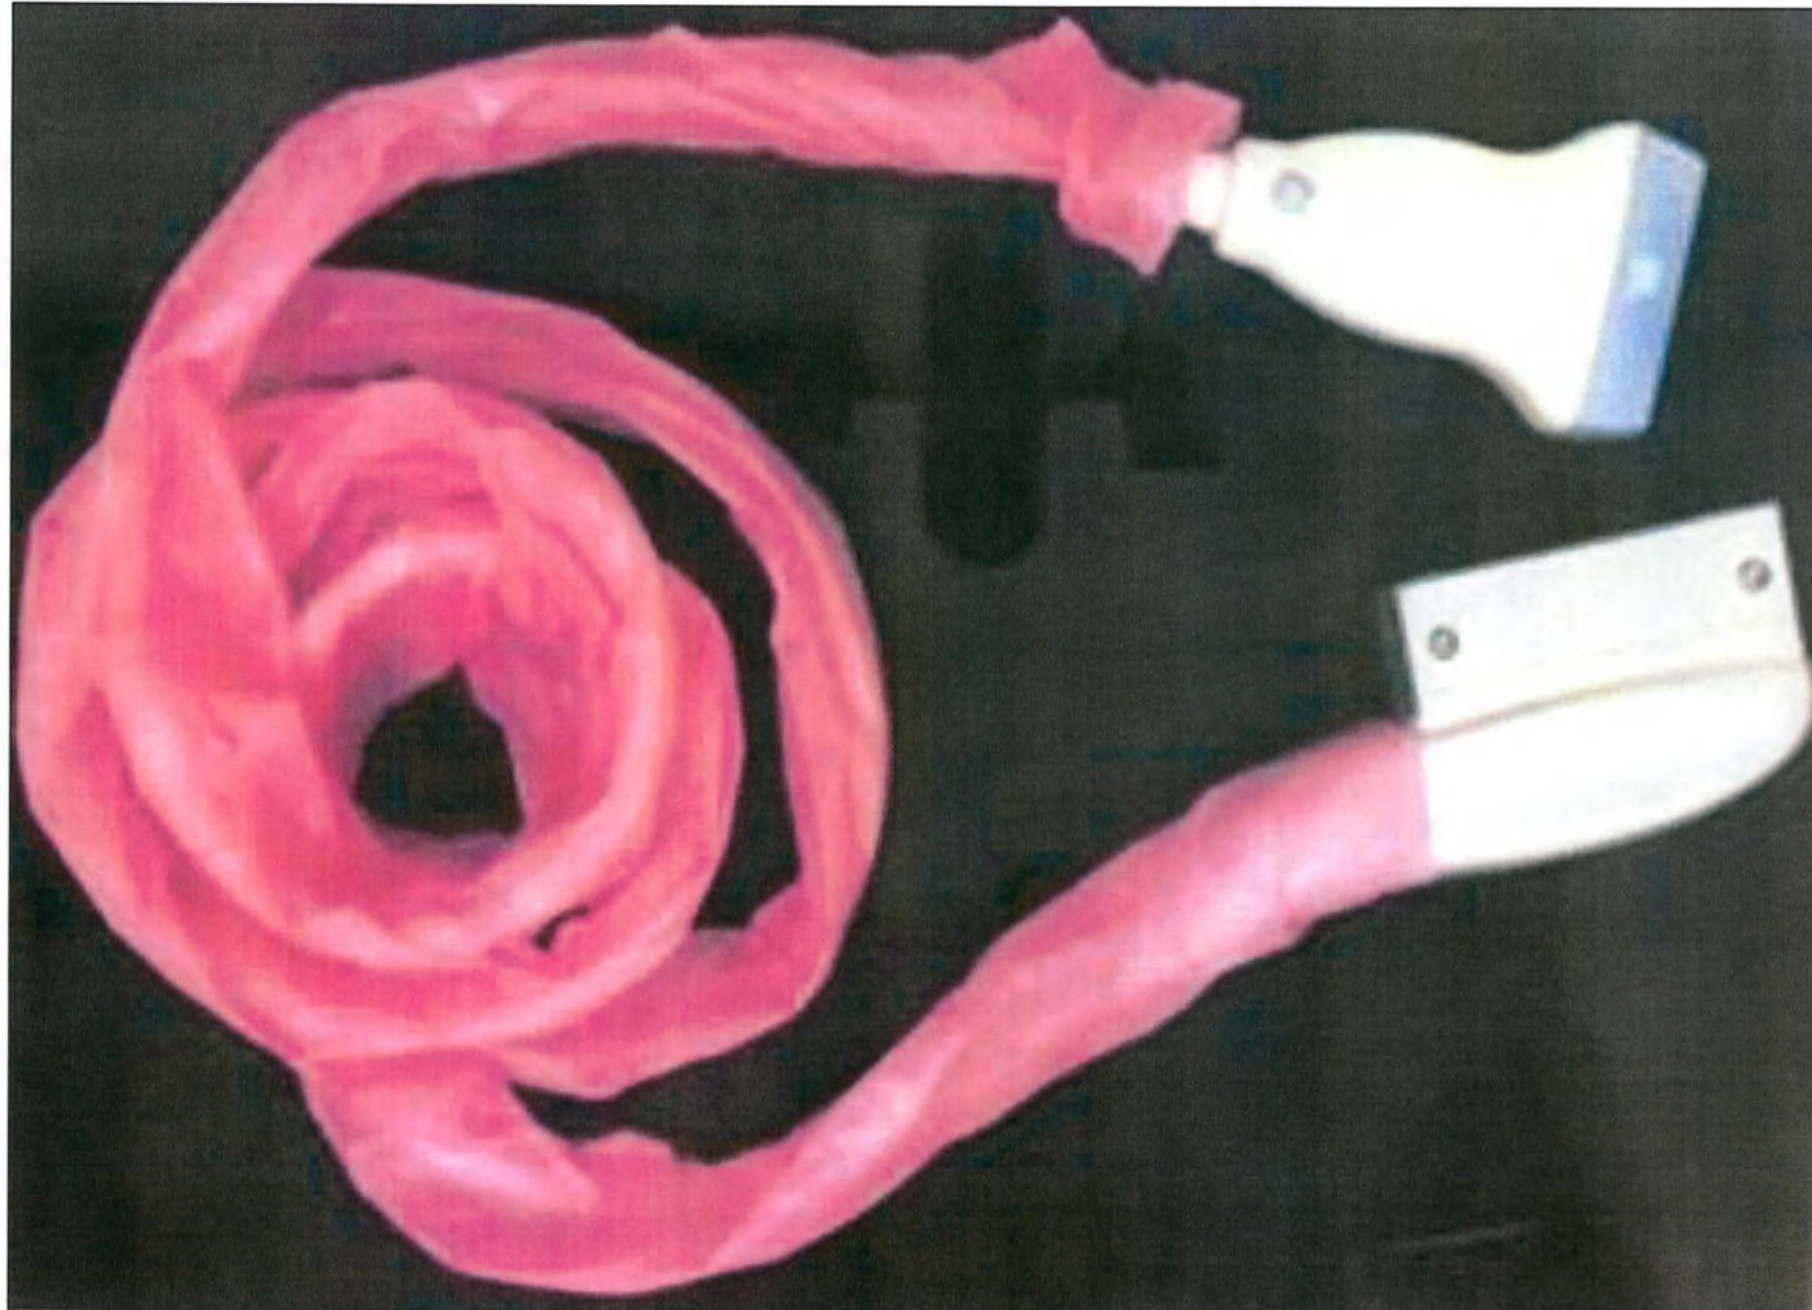


Датчик линейный 12L-RS.




Датчик линейный матричный ML6-15-RS.

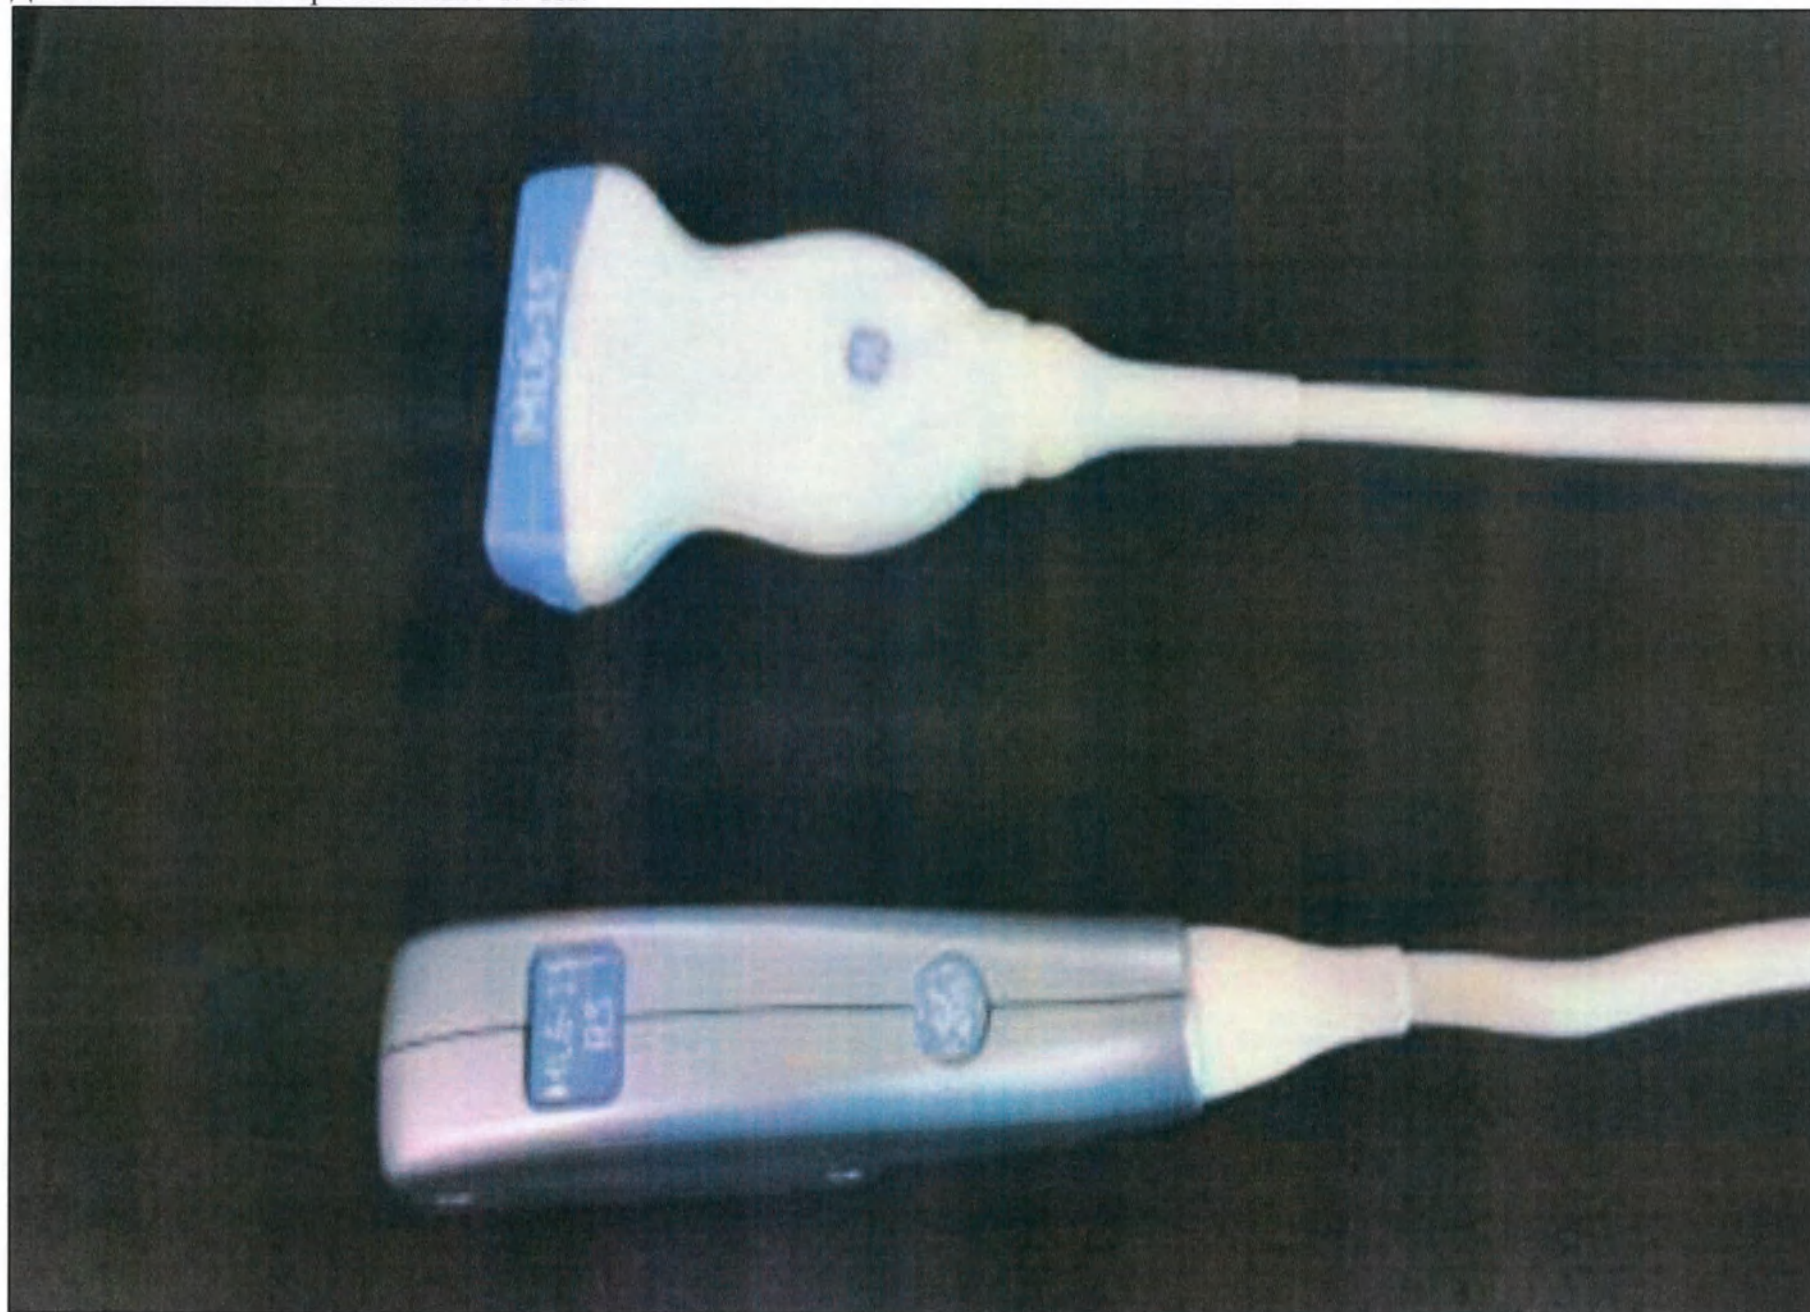


Датчик линейный L4-20t-RS

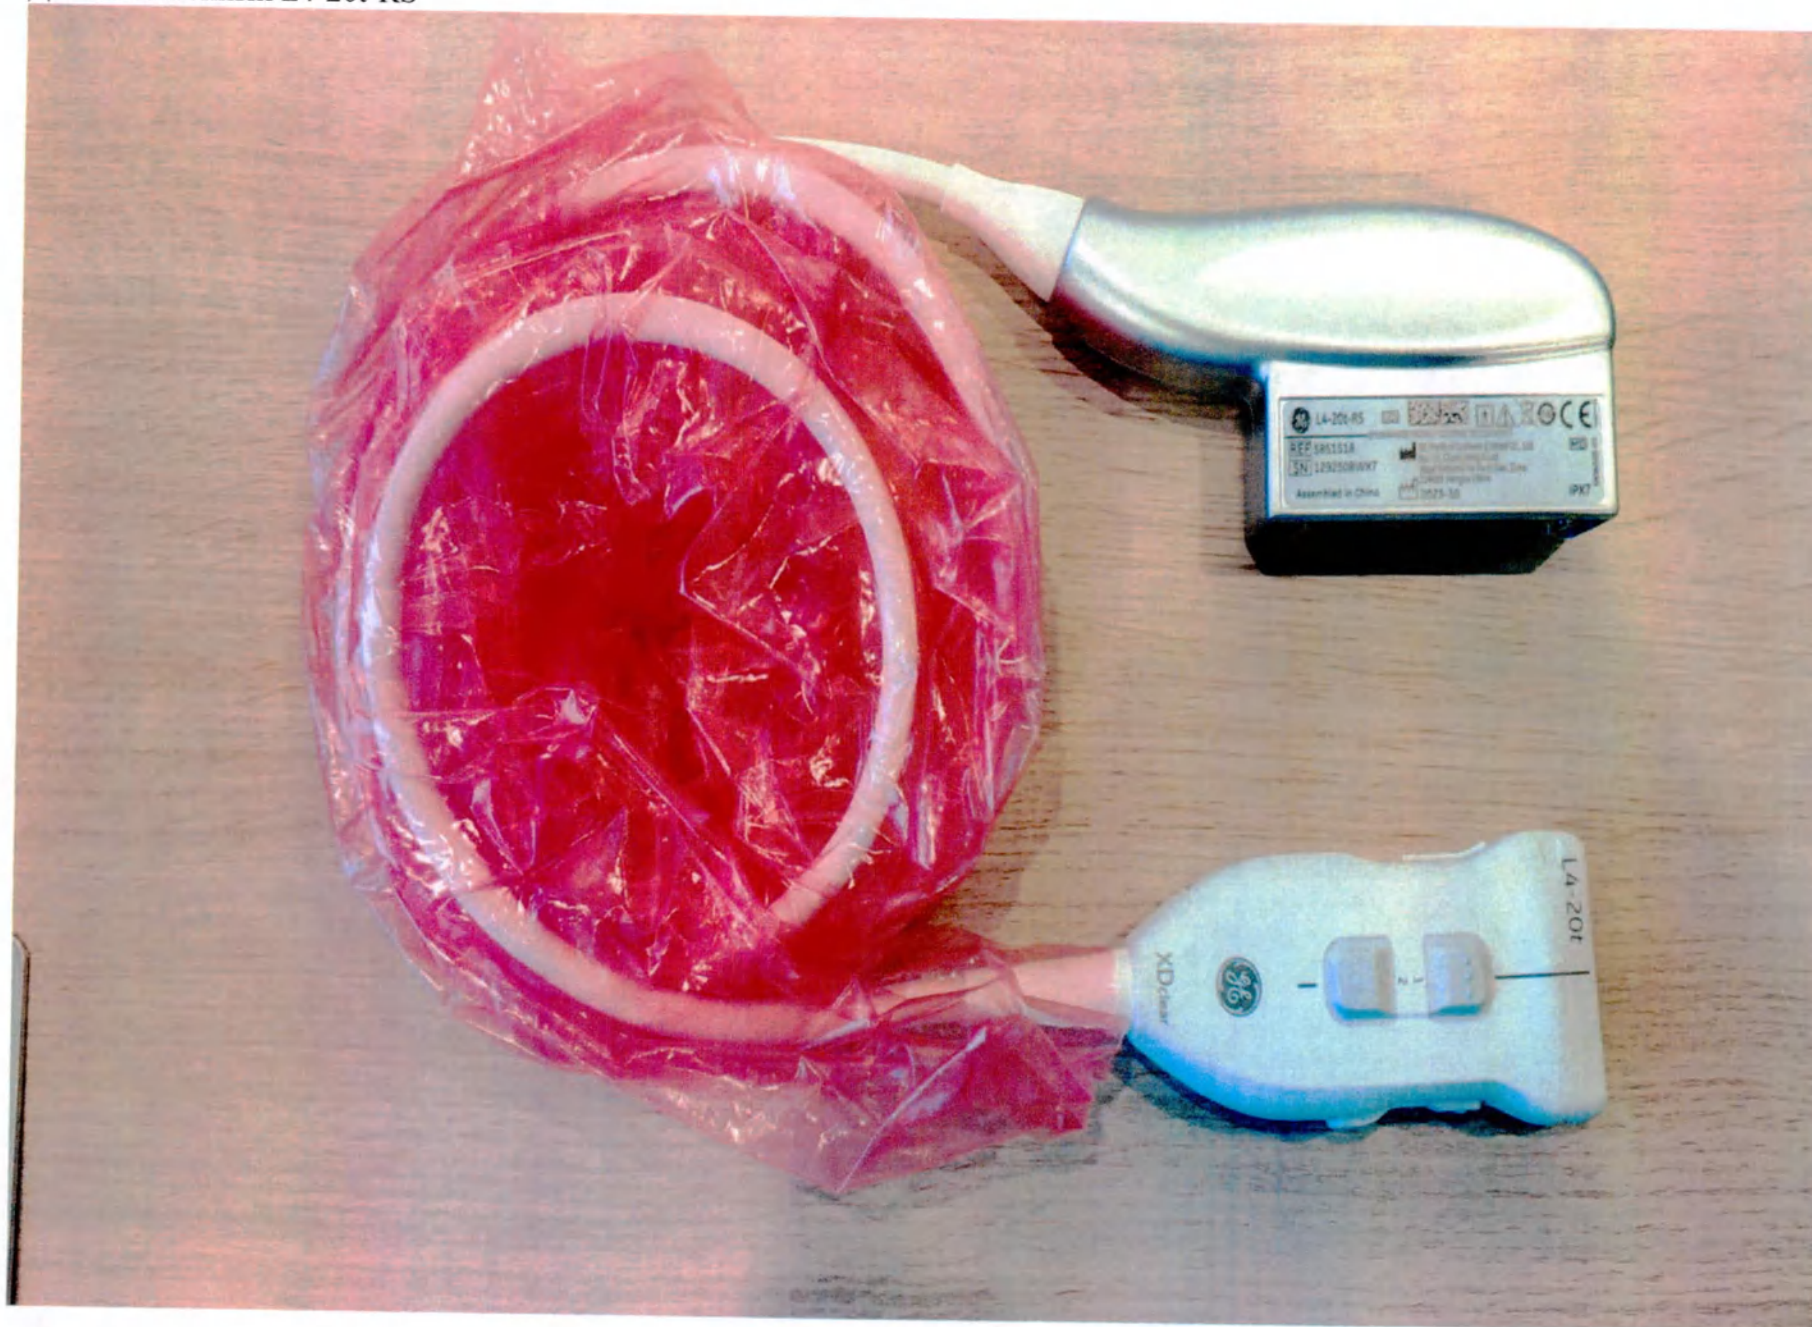


Датчик конвексный 4С-RS.

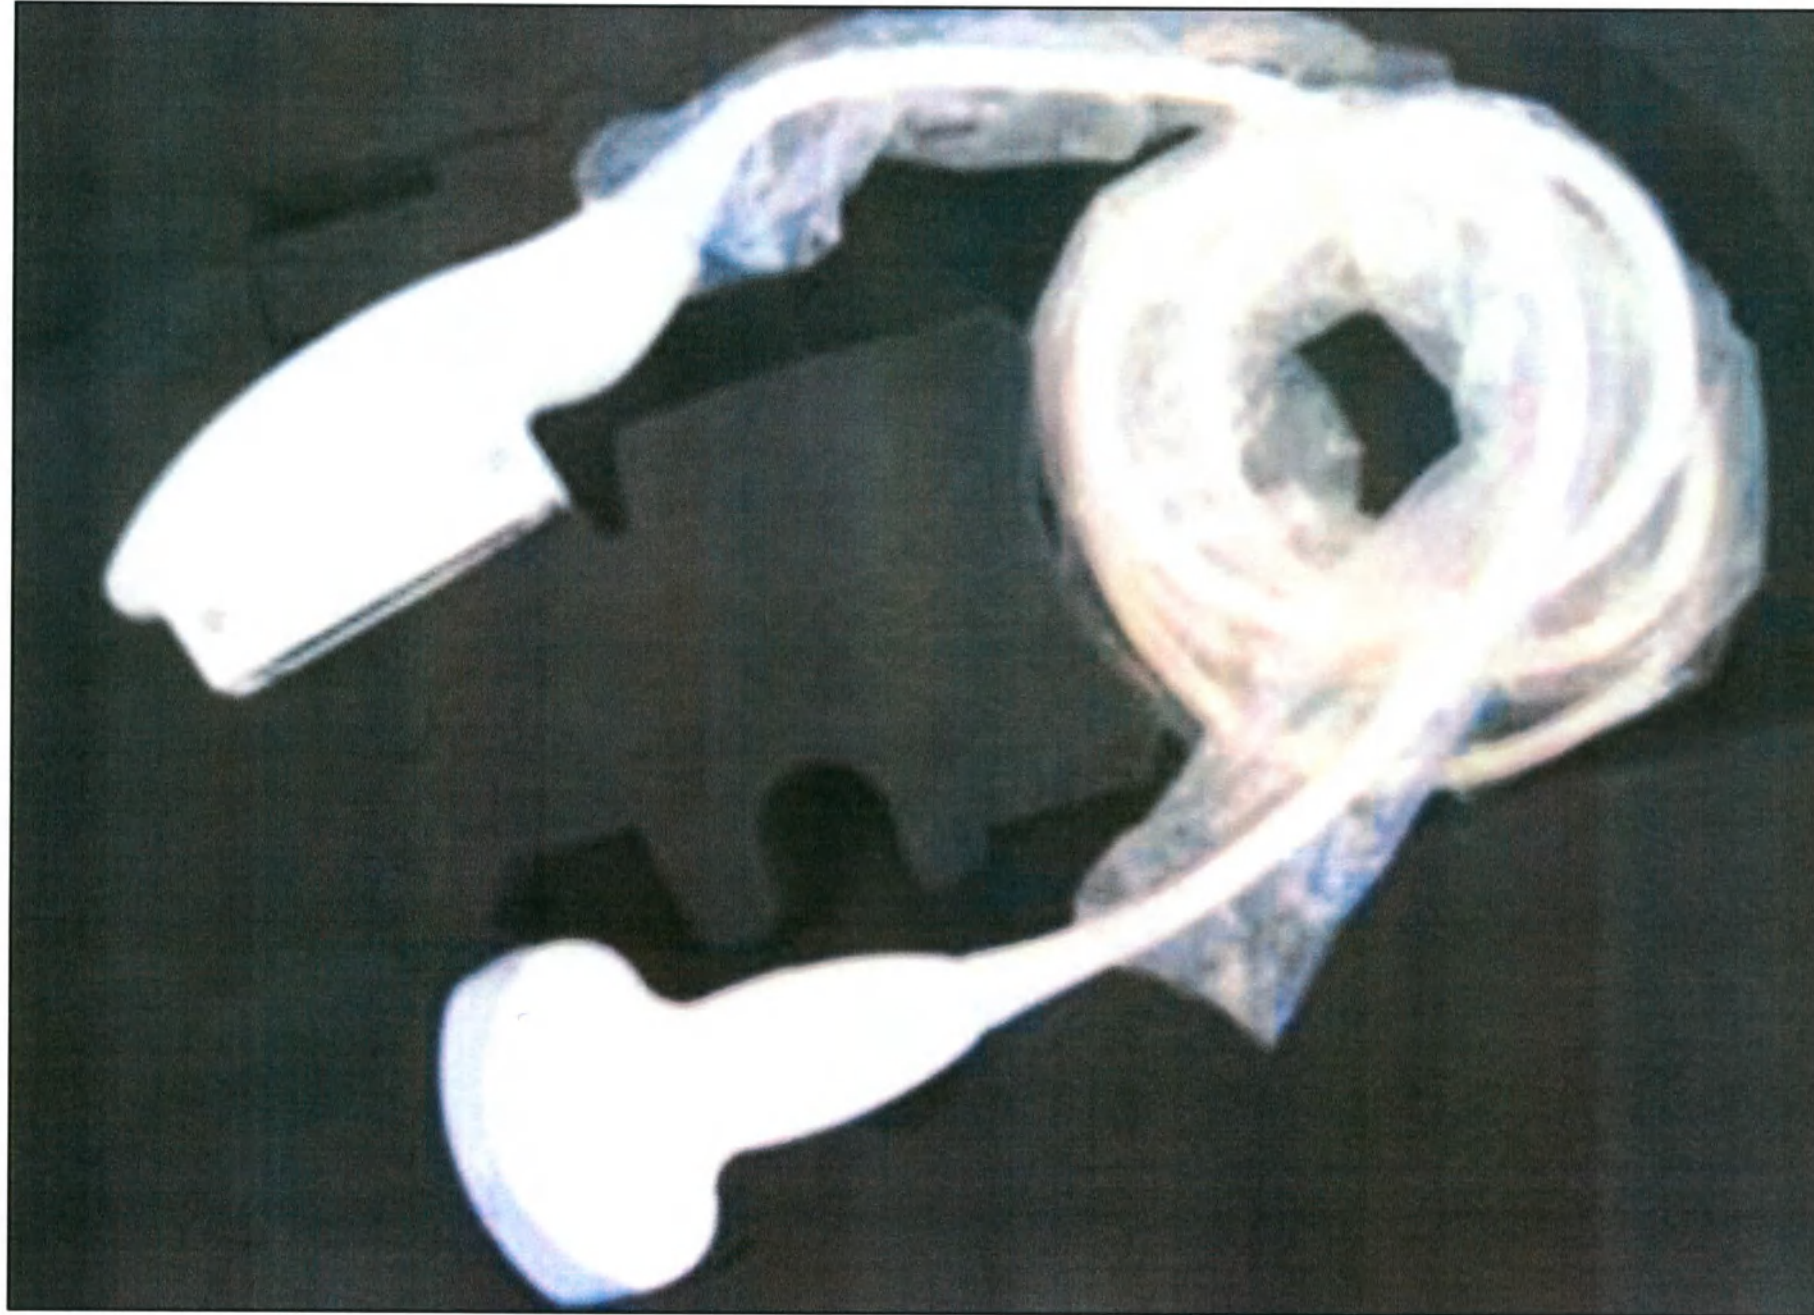


Датчик микроконвексный 8С-RS.

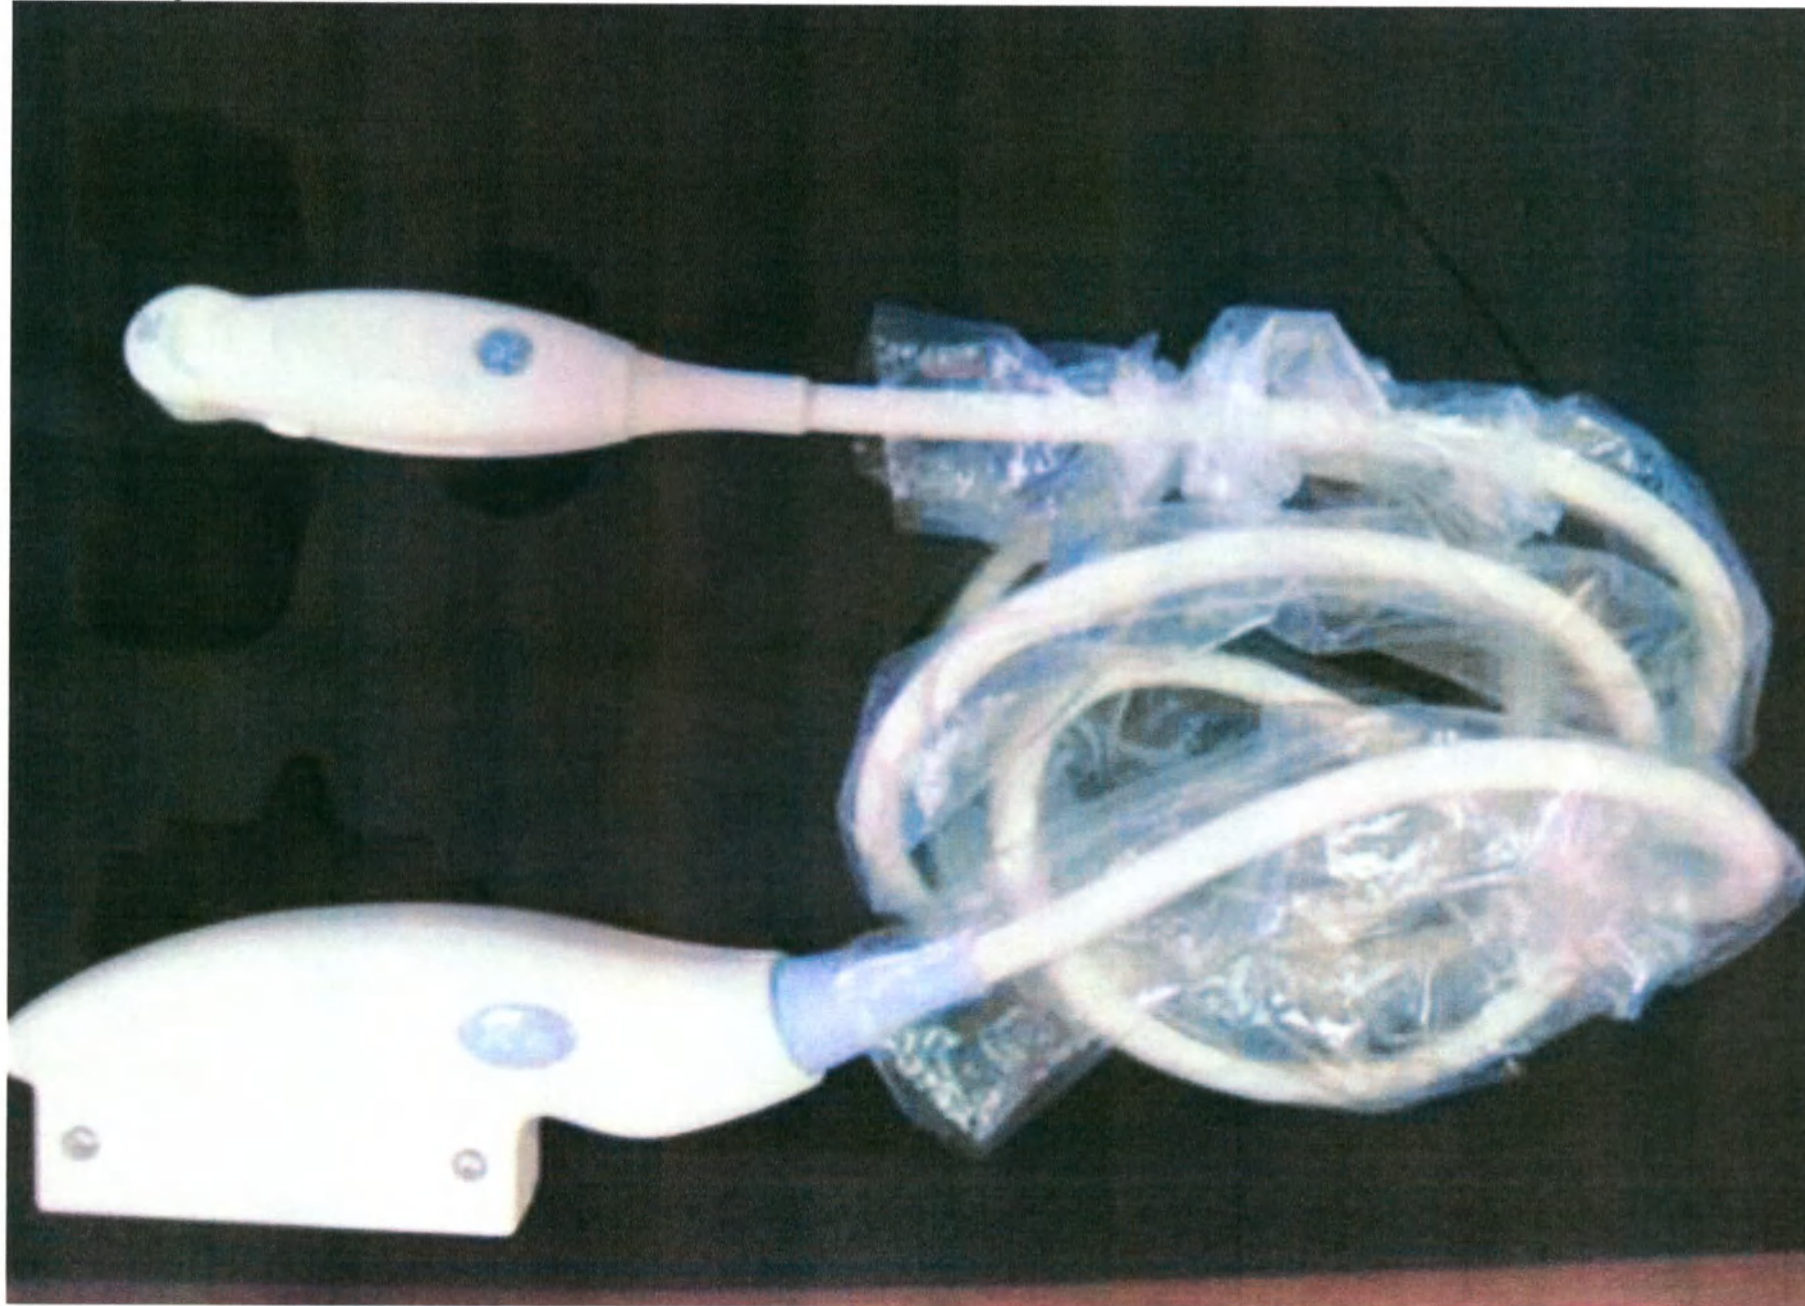

Датчик конвексный С1-5-RS.

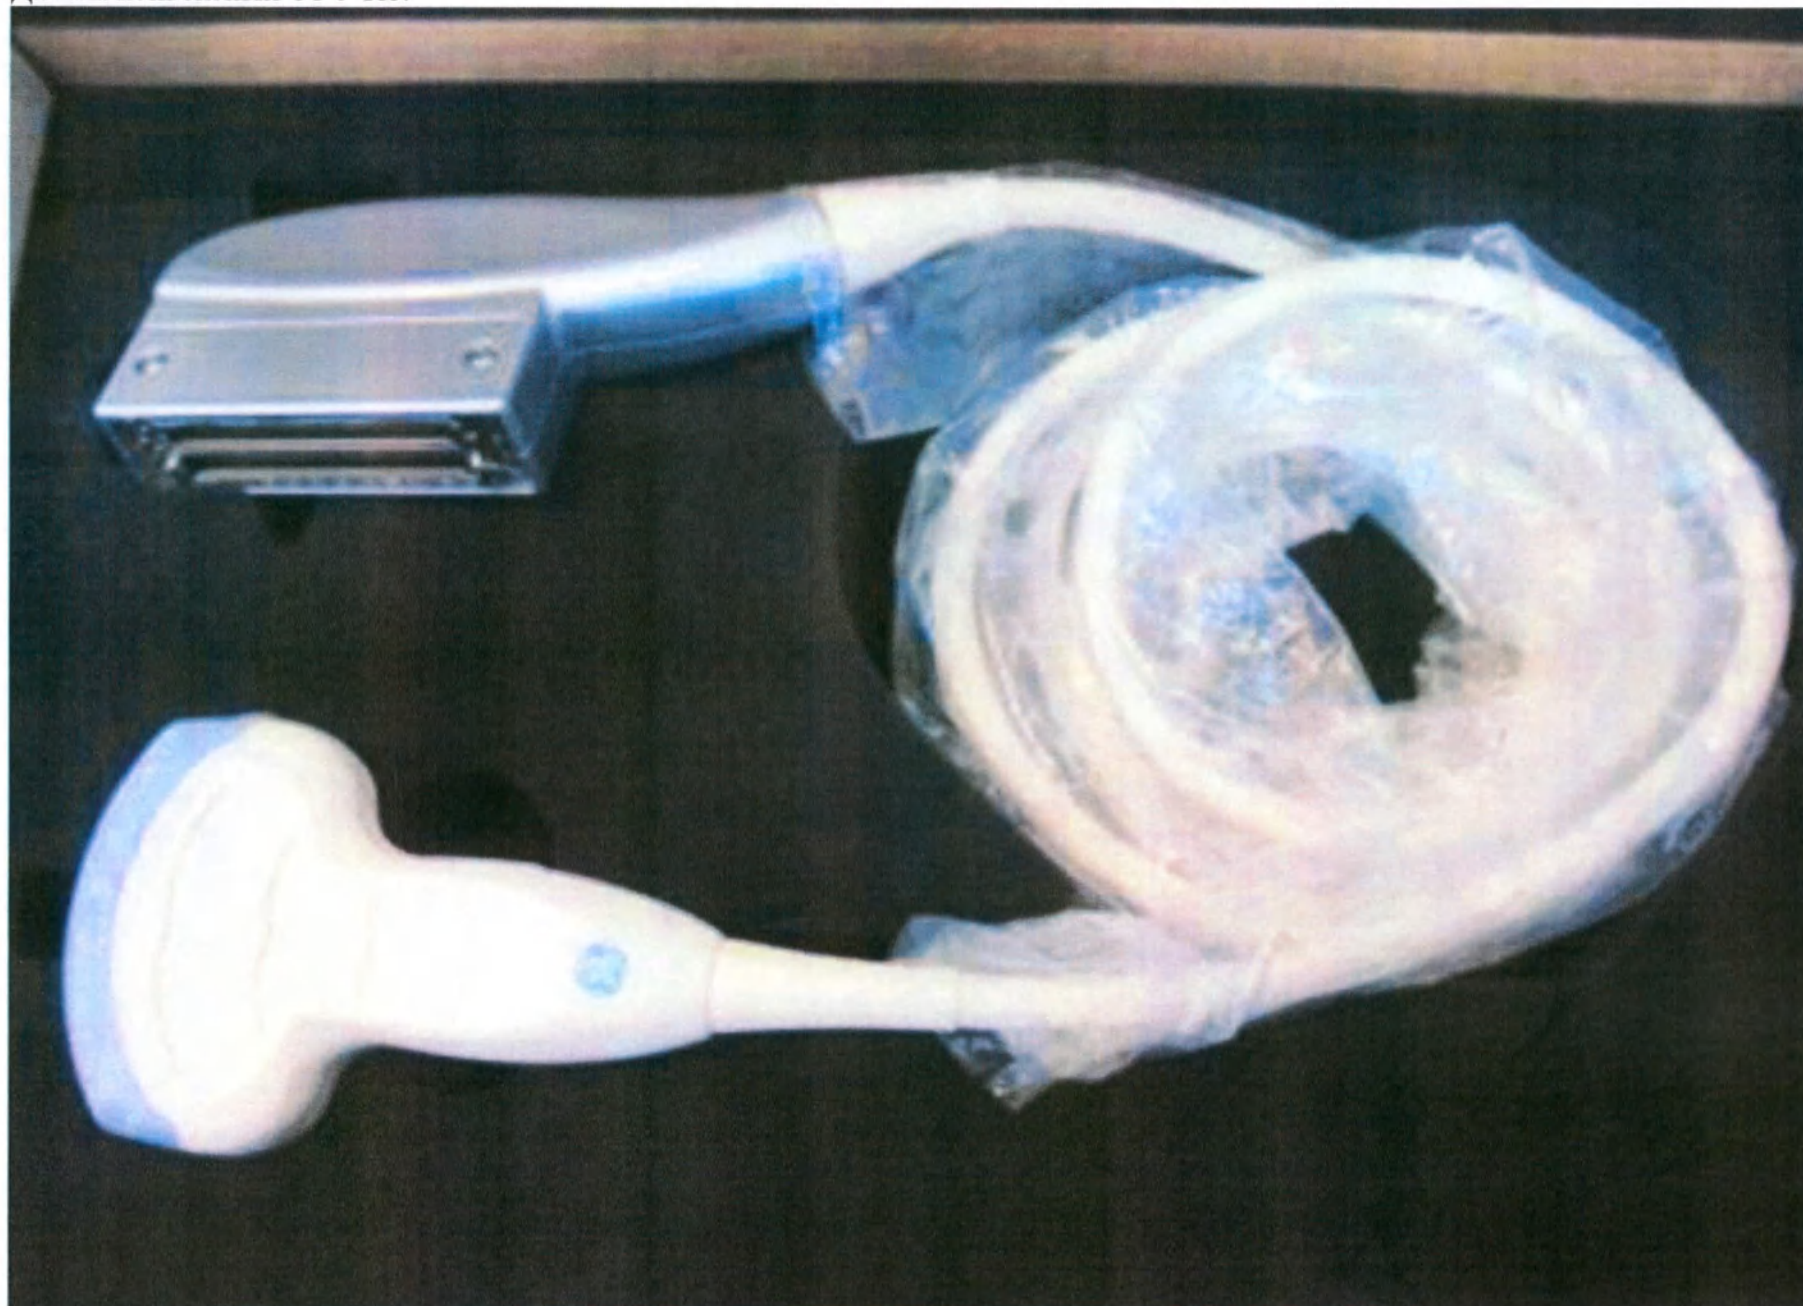


Датчик микроконвексный эндовагинальный E8CS-RS.

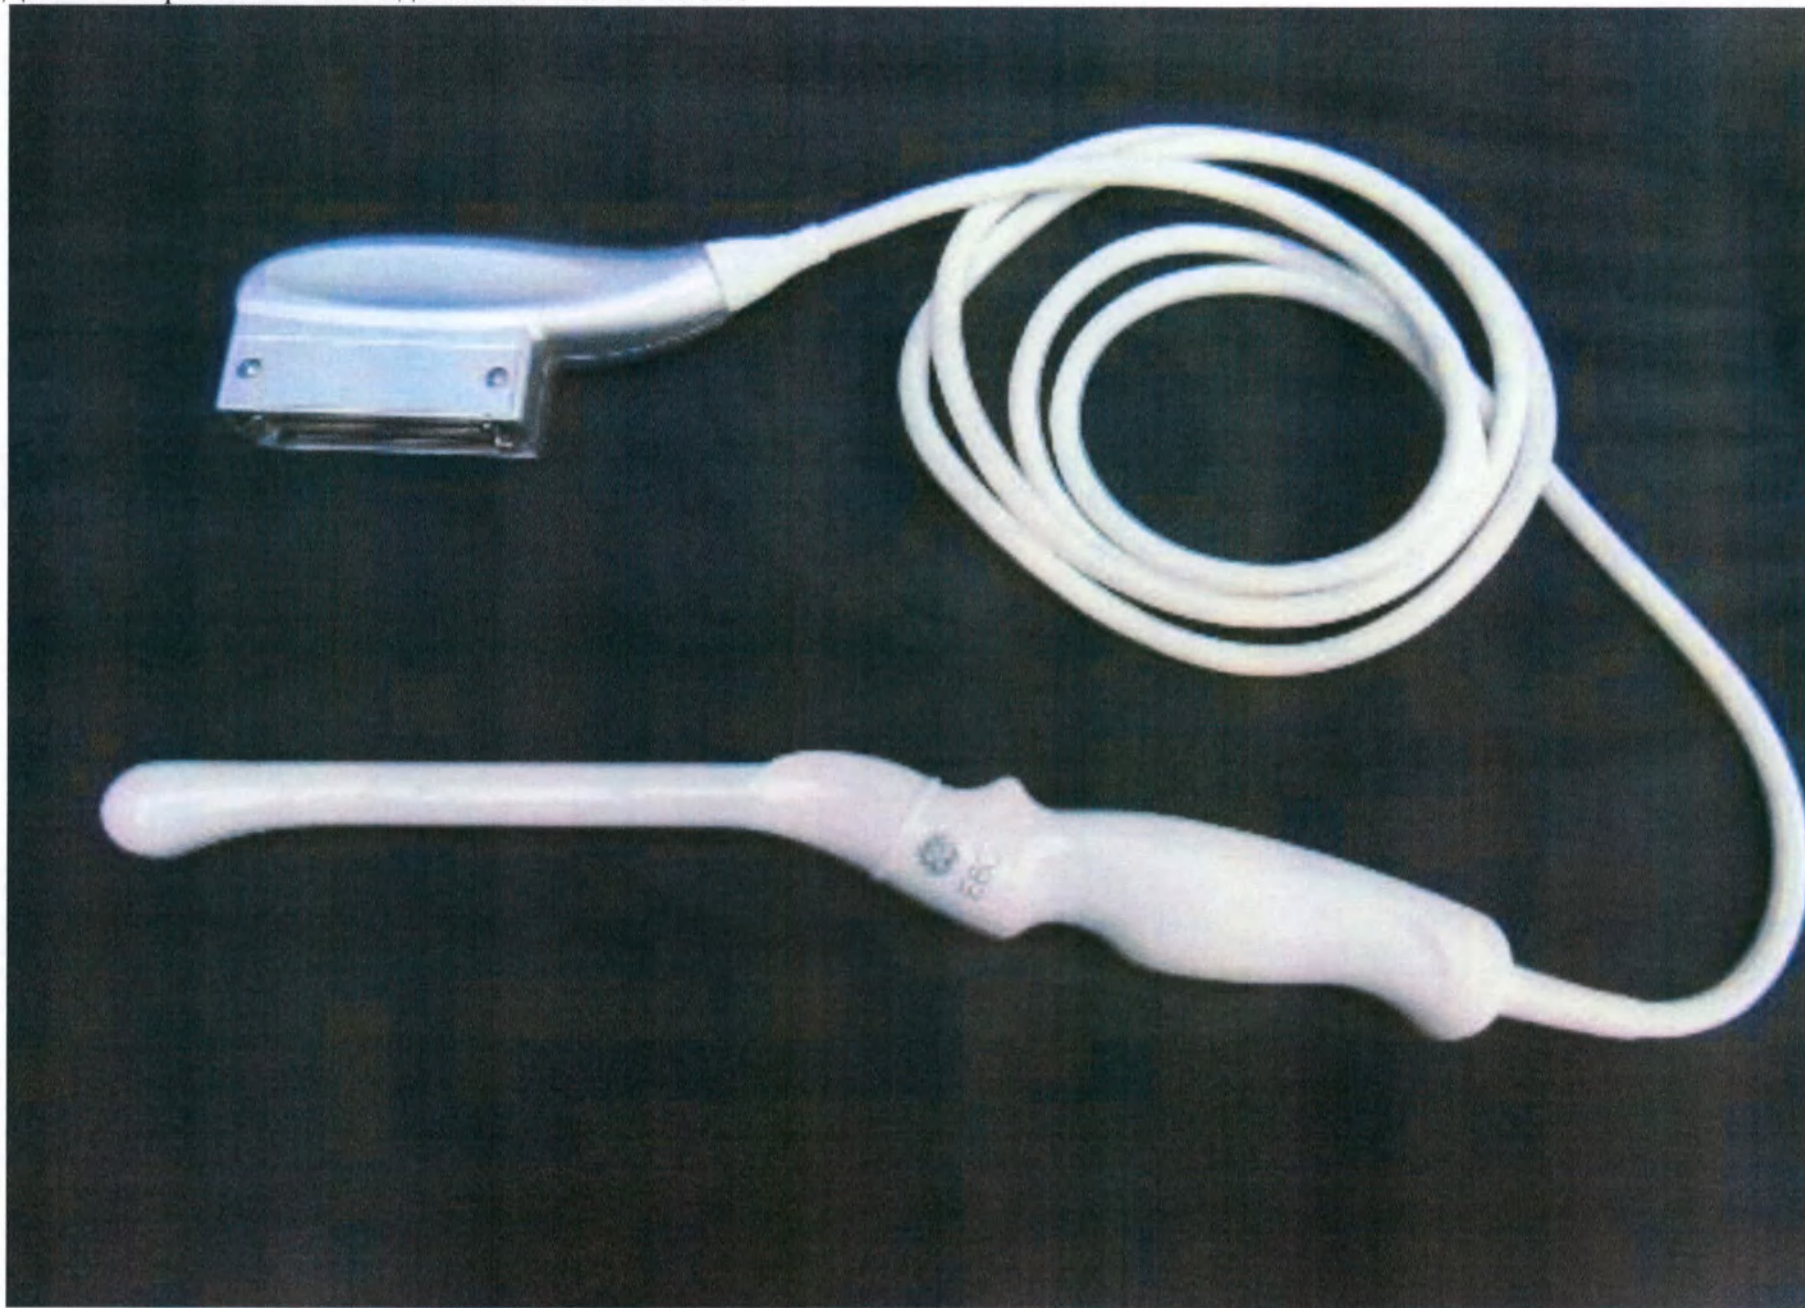

Датчик линейный интраоперационный L8-18i-RS.




Датчик секторный фазированный чреспищеводный 6Тс-RS.

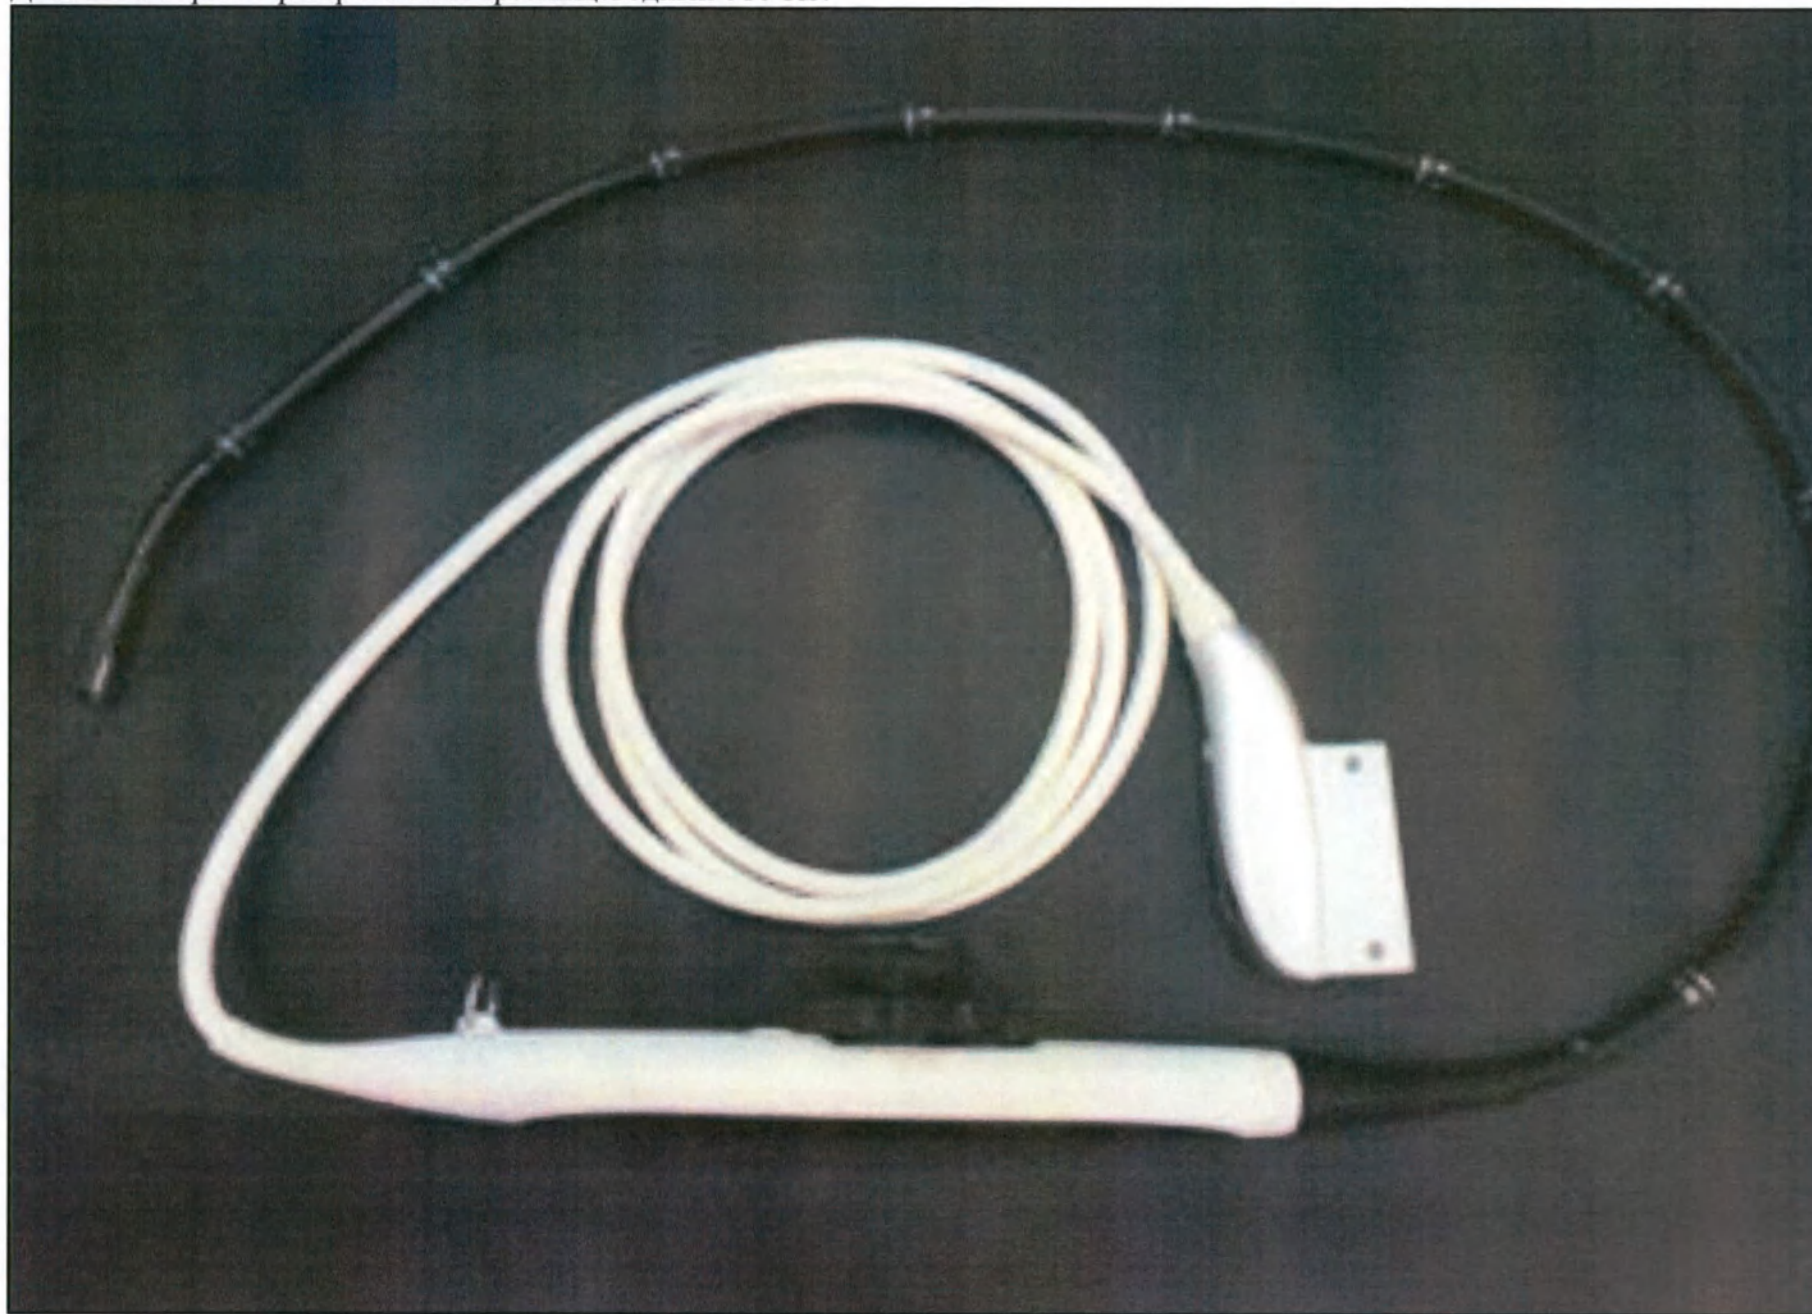

Датчик секторный фазированный чреспищеводный 9Т-RS.





Датчик секторный фазированный чреспищеводный матричный мультимастотный для объемной визуализации 6VT-D

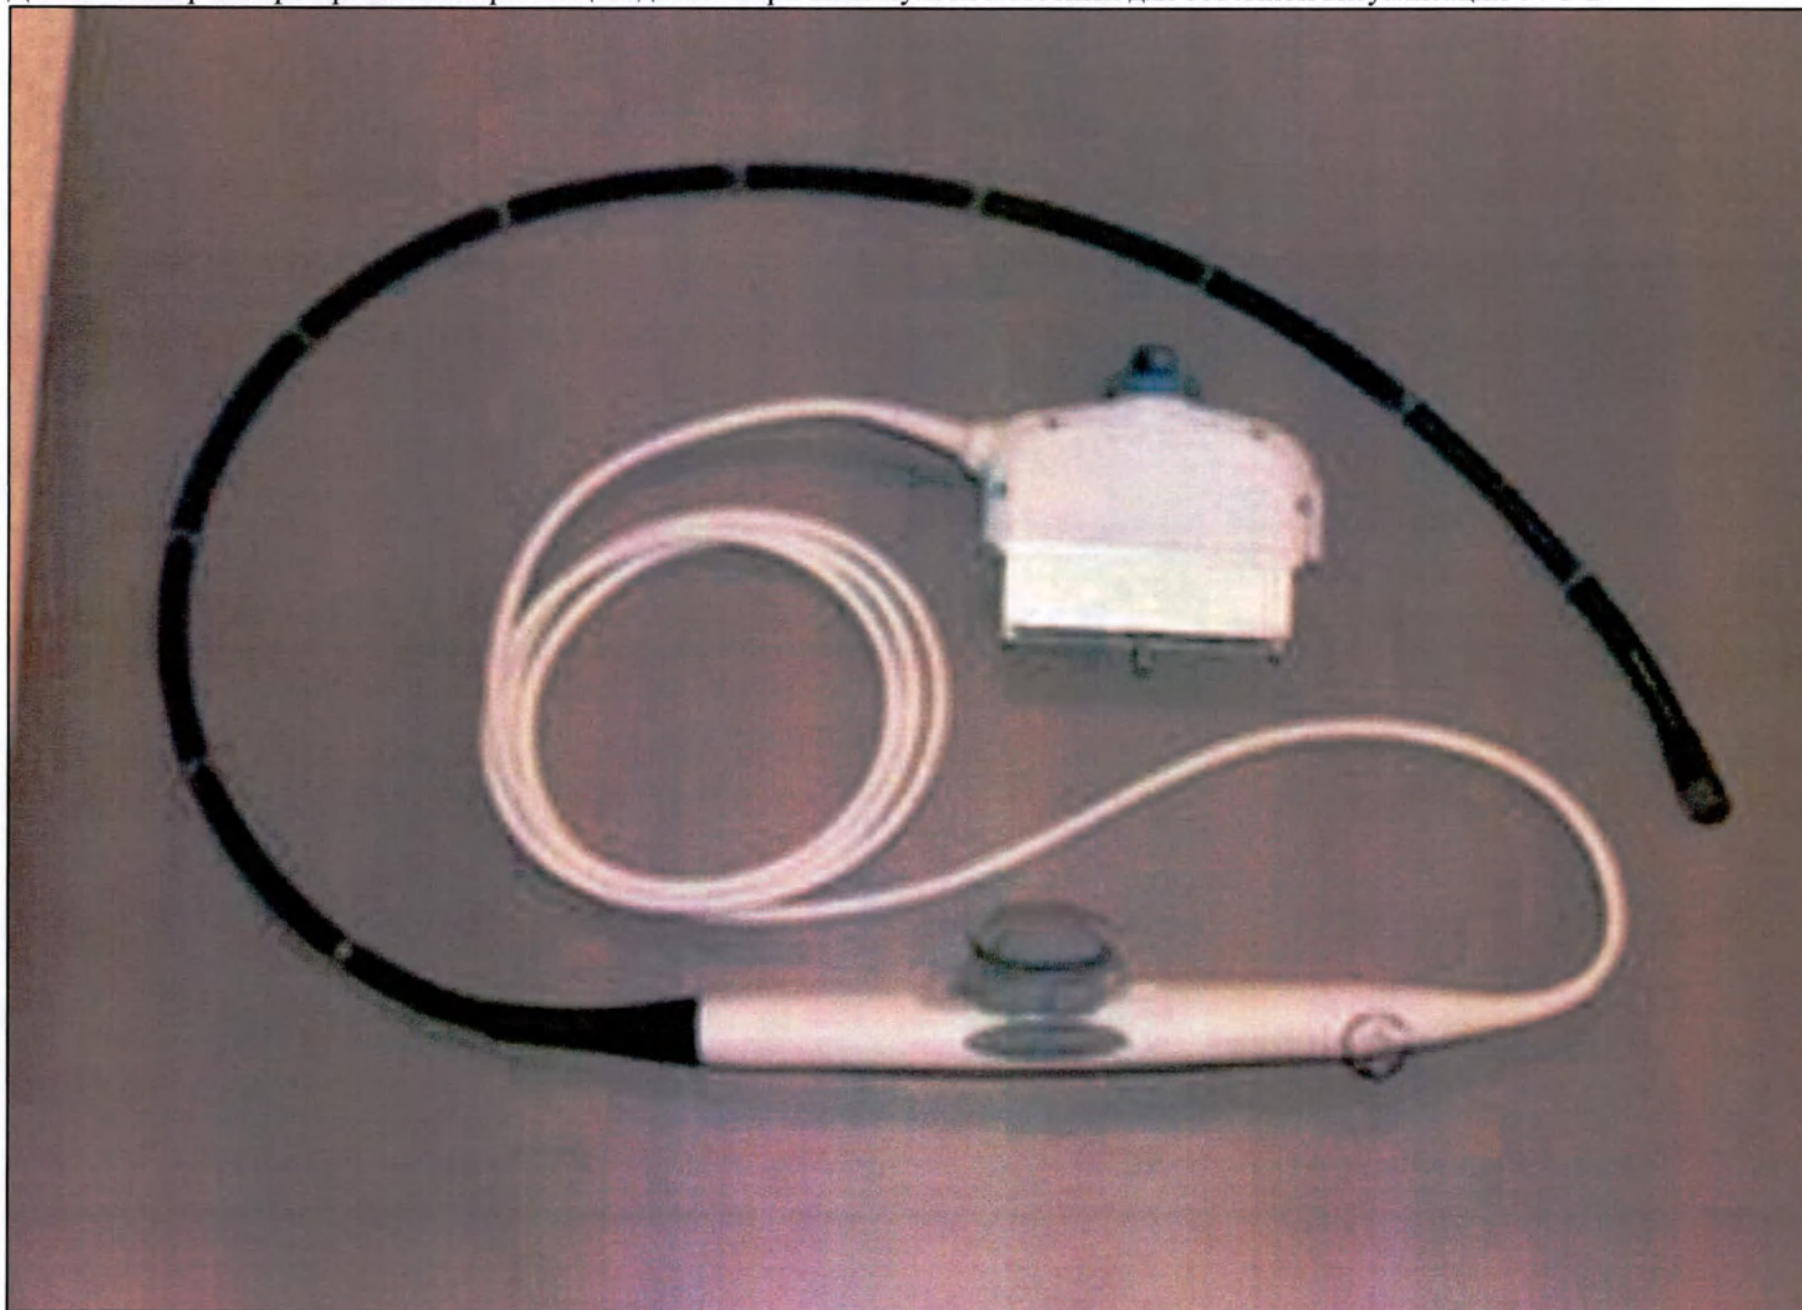


Датчик секторный невизуализирующий доплеровский P2D.




Макет маркировки для Датчик секторный фазированный 3Sc-RS, Датчик секторный фазированный 6S-RS, Датчик секторный фазированный 12S-RS, Датчик секторный фазированный матричный M5Sc-RS, Датчик линейный 9L-RS, Датчик линейный 12L-RS, Датчик линейный матричный ML6-15-RS, Датчик линейный L4-20t-RS, Датчик конвексный 4C-RS, Датчик микроконвексный 8C-RS, Датчик конвексный C1-5-RS, Датчик микроконвексный эндовагинальный E8CS-RS, Датчик линейный интраоперационный L8-18i-RS, Датчик секторный фазированный чреспищеводный 6Tc-RS, Датчик секторный фазированный чреспищеводный 9T-RS, Датчик секторный фазированный чреспищеводный матричный мультичастотный для объемной визуализации 6VT-D.

1 	2	3	4 	5	6 	7 	8 	9 
(01)00840682109994(11)160500(21)203223YP3								
10 		13 						
11 		14 						
12		15	16 IP					

Держатель для невизуализирующего доплеровского датчика.

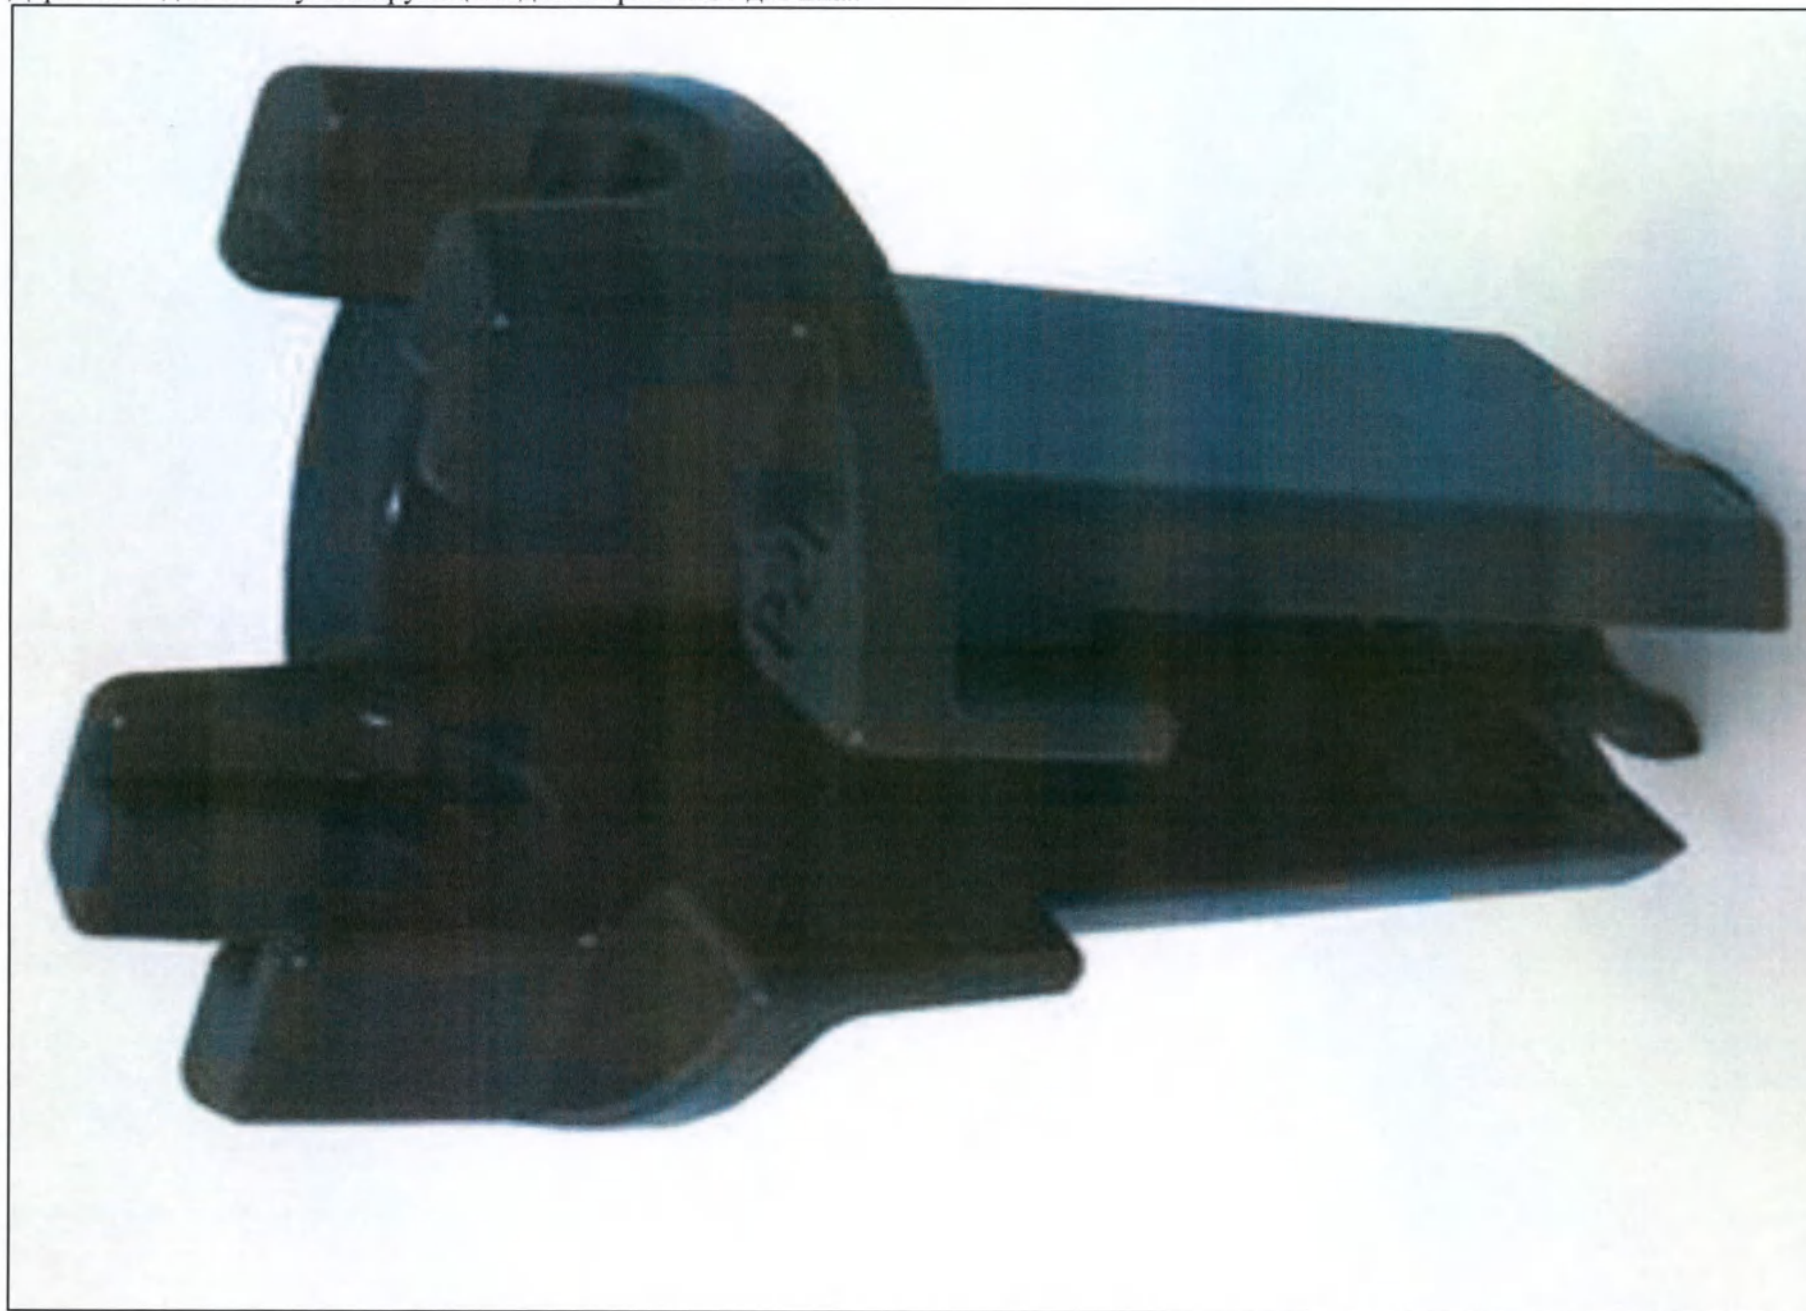


Коннектор для подключения внутрисердечного датчика с ферритовым фильтром.

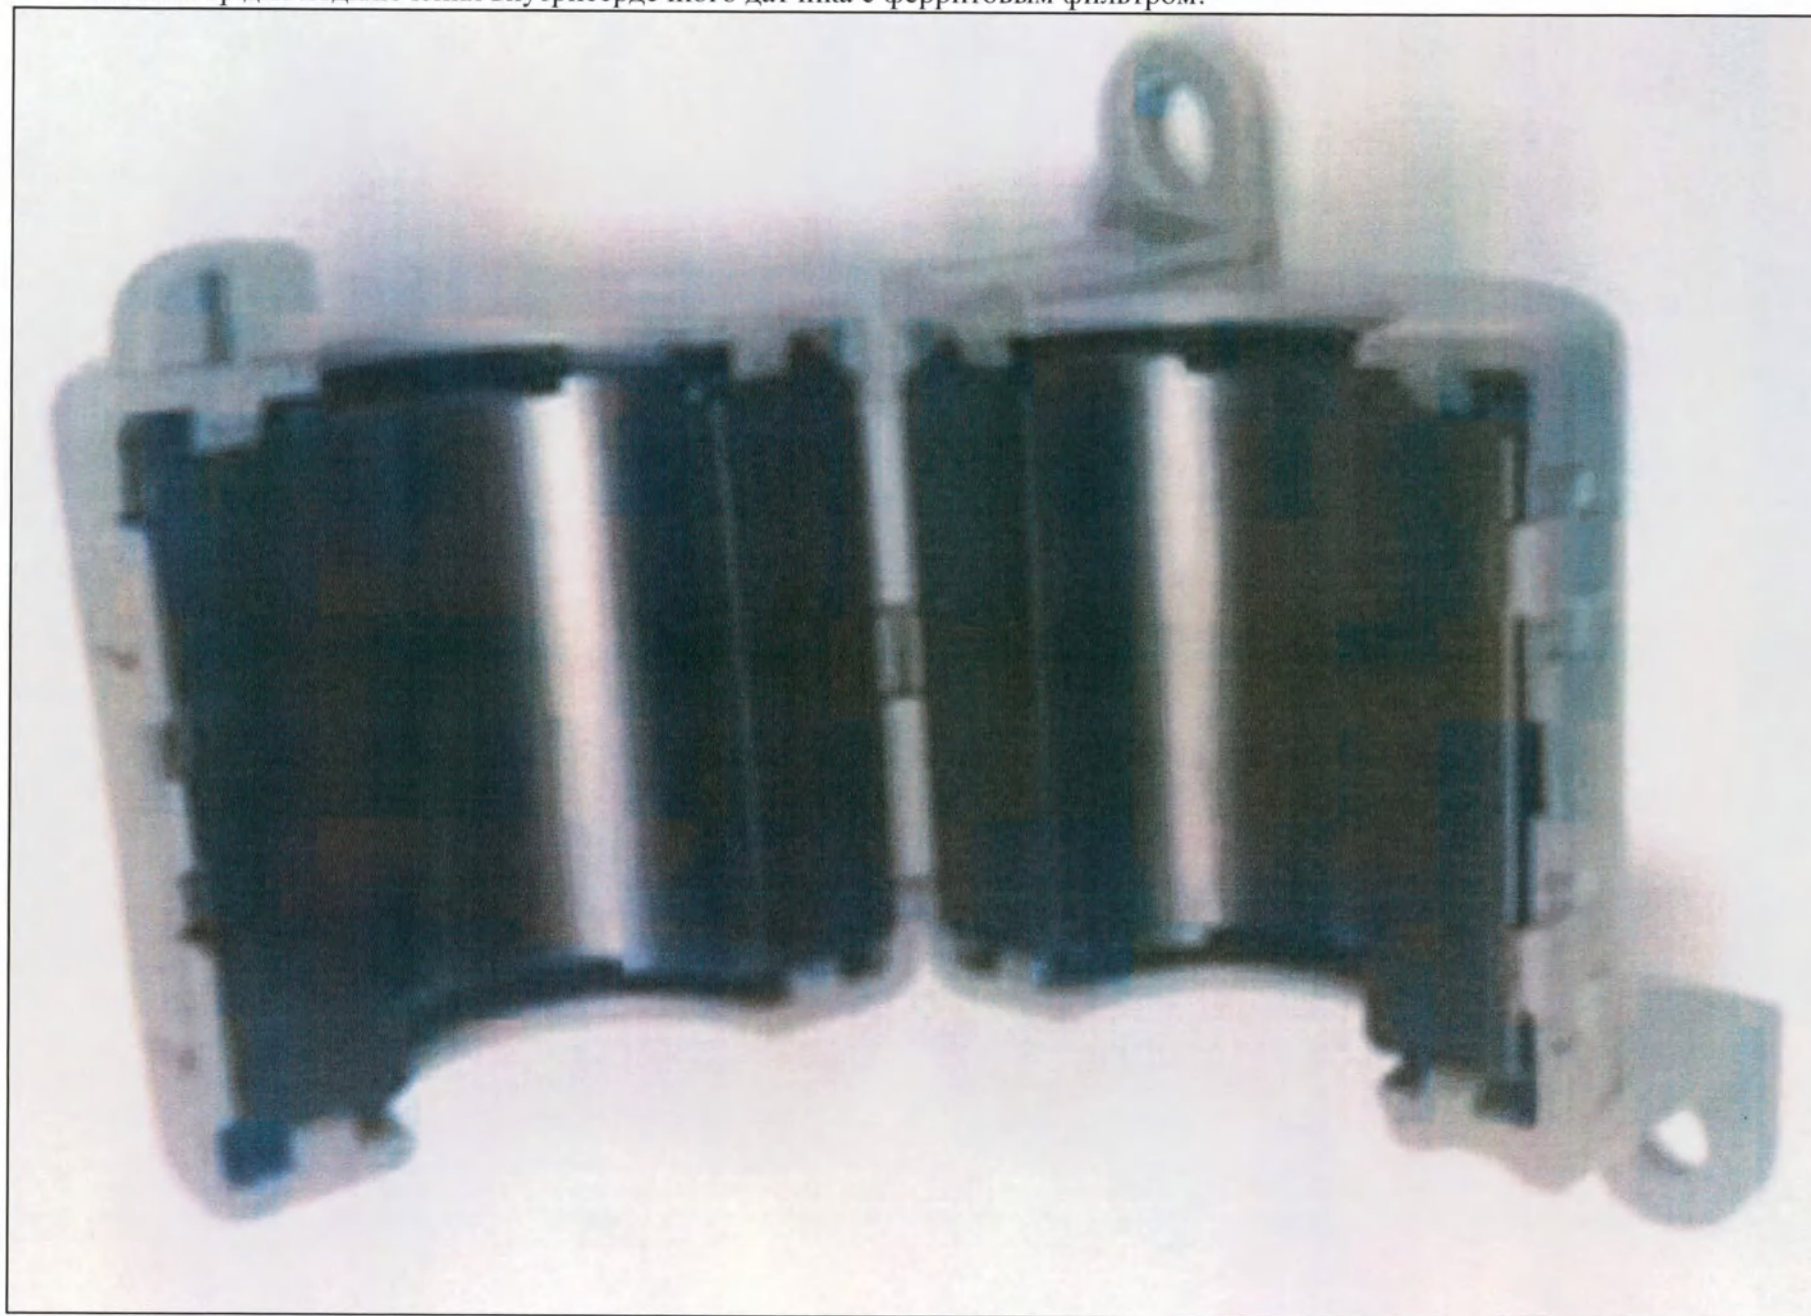


Насадки биопсийные M5S-D для секторных фазированных матричных датчиков



Насадки биопсийные 3Sp для секторных фазированных датчиков.

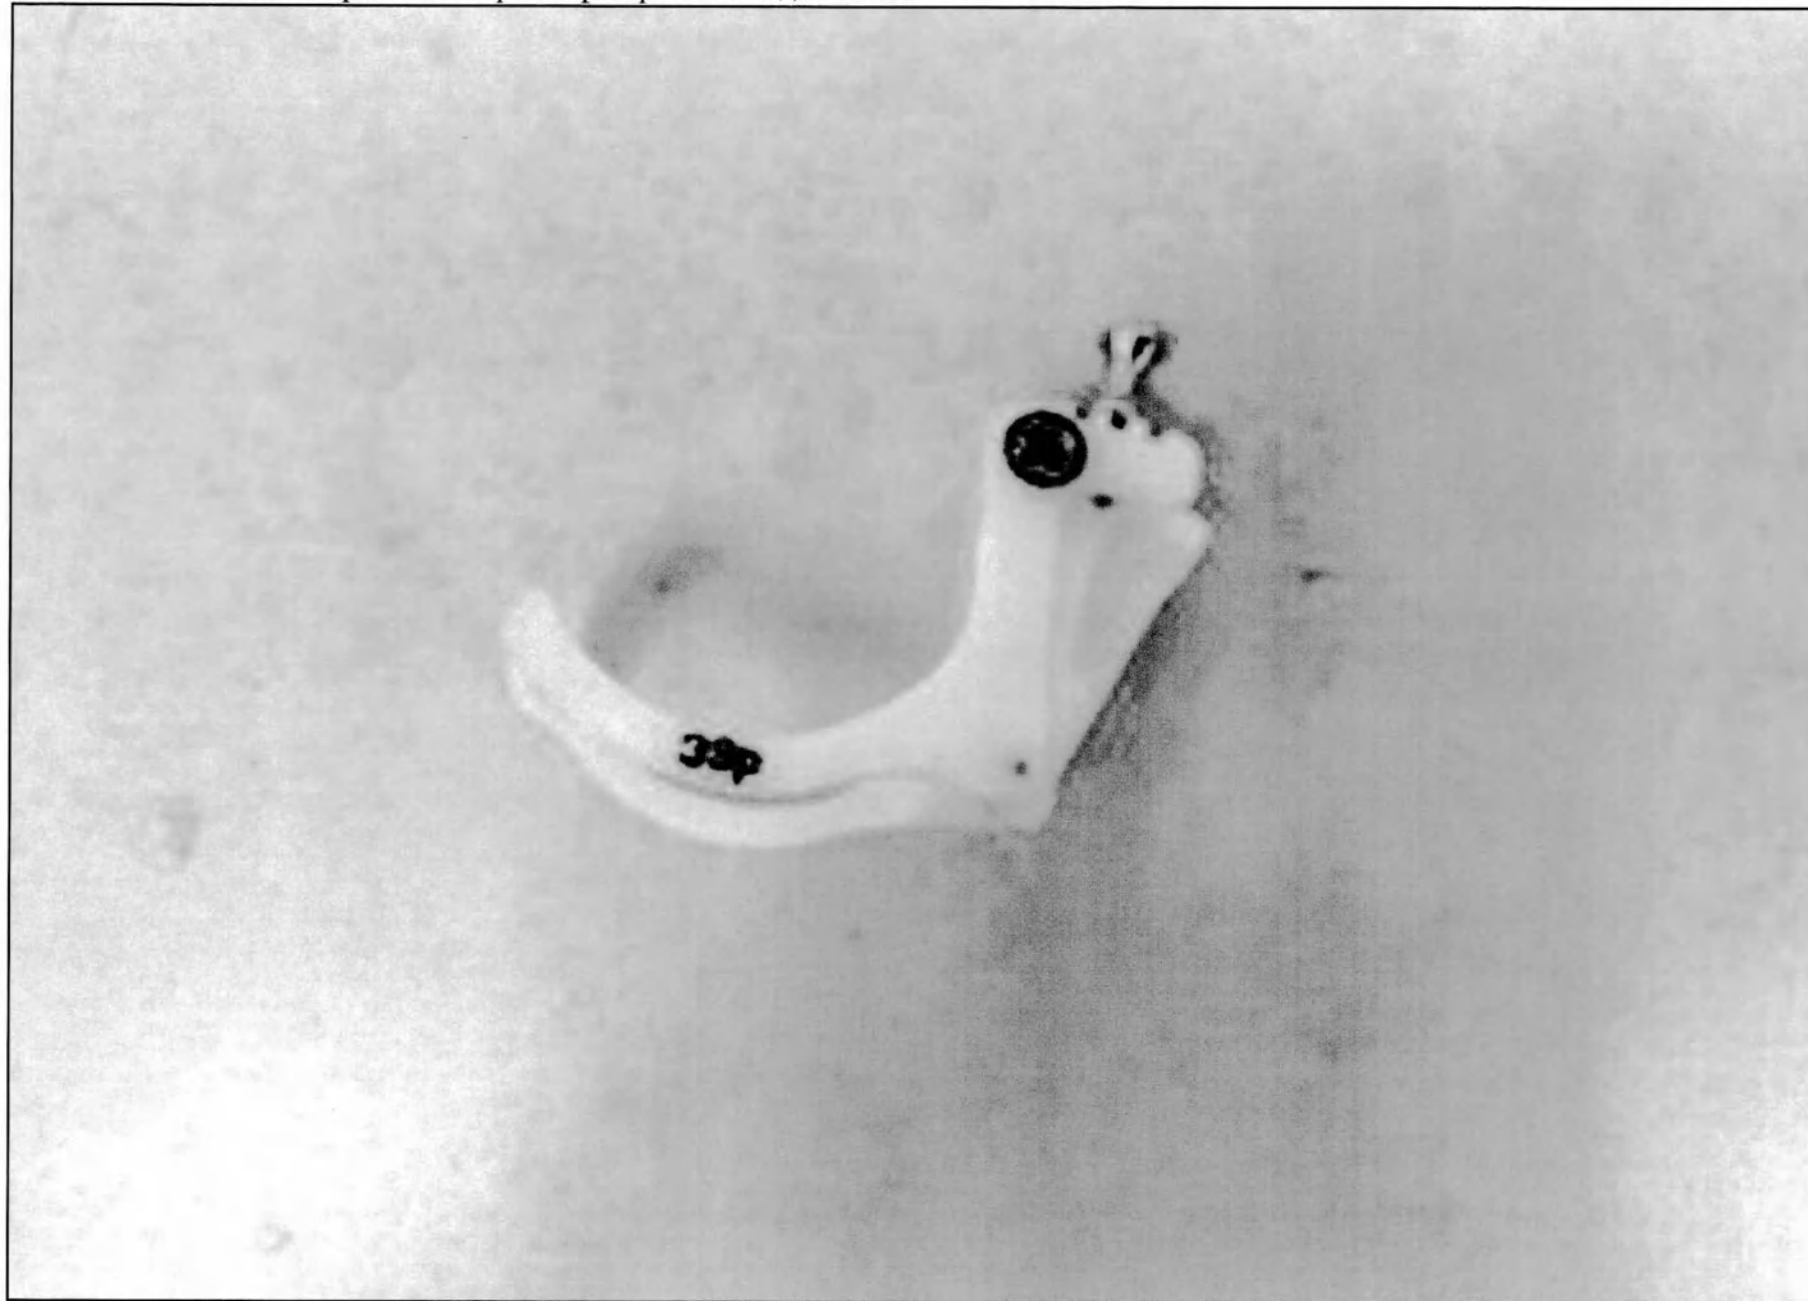

Набор начальный для биопсии M3S/3S: биопсийный угол и направляющая для биопсийной иглы.

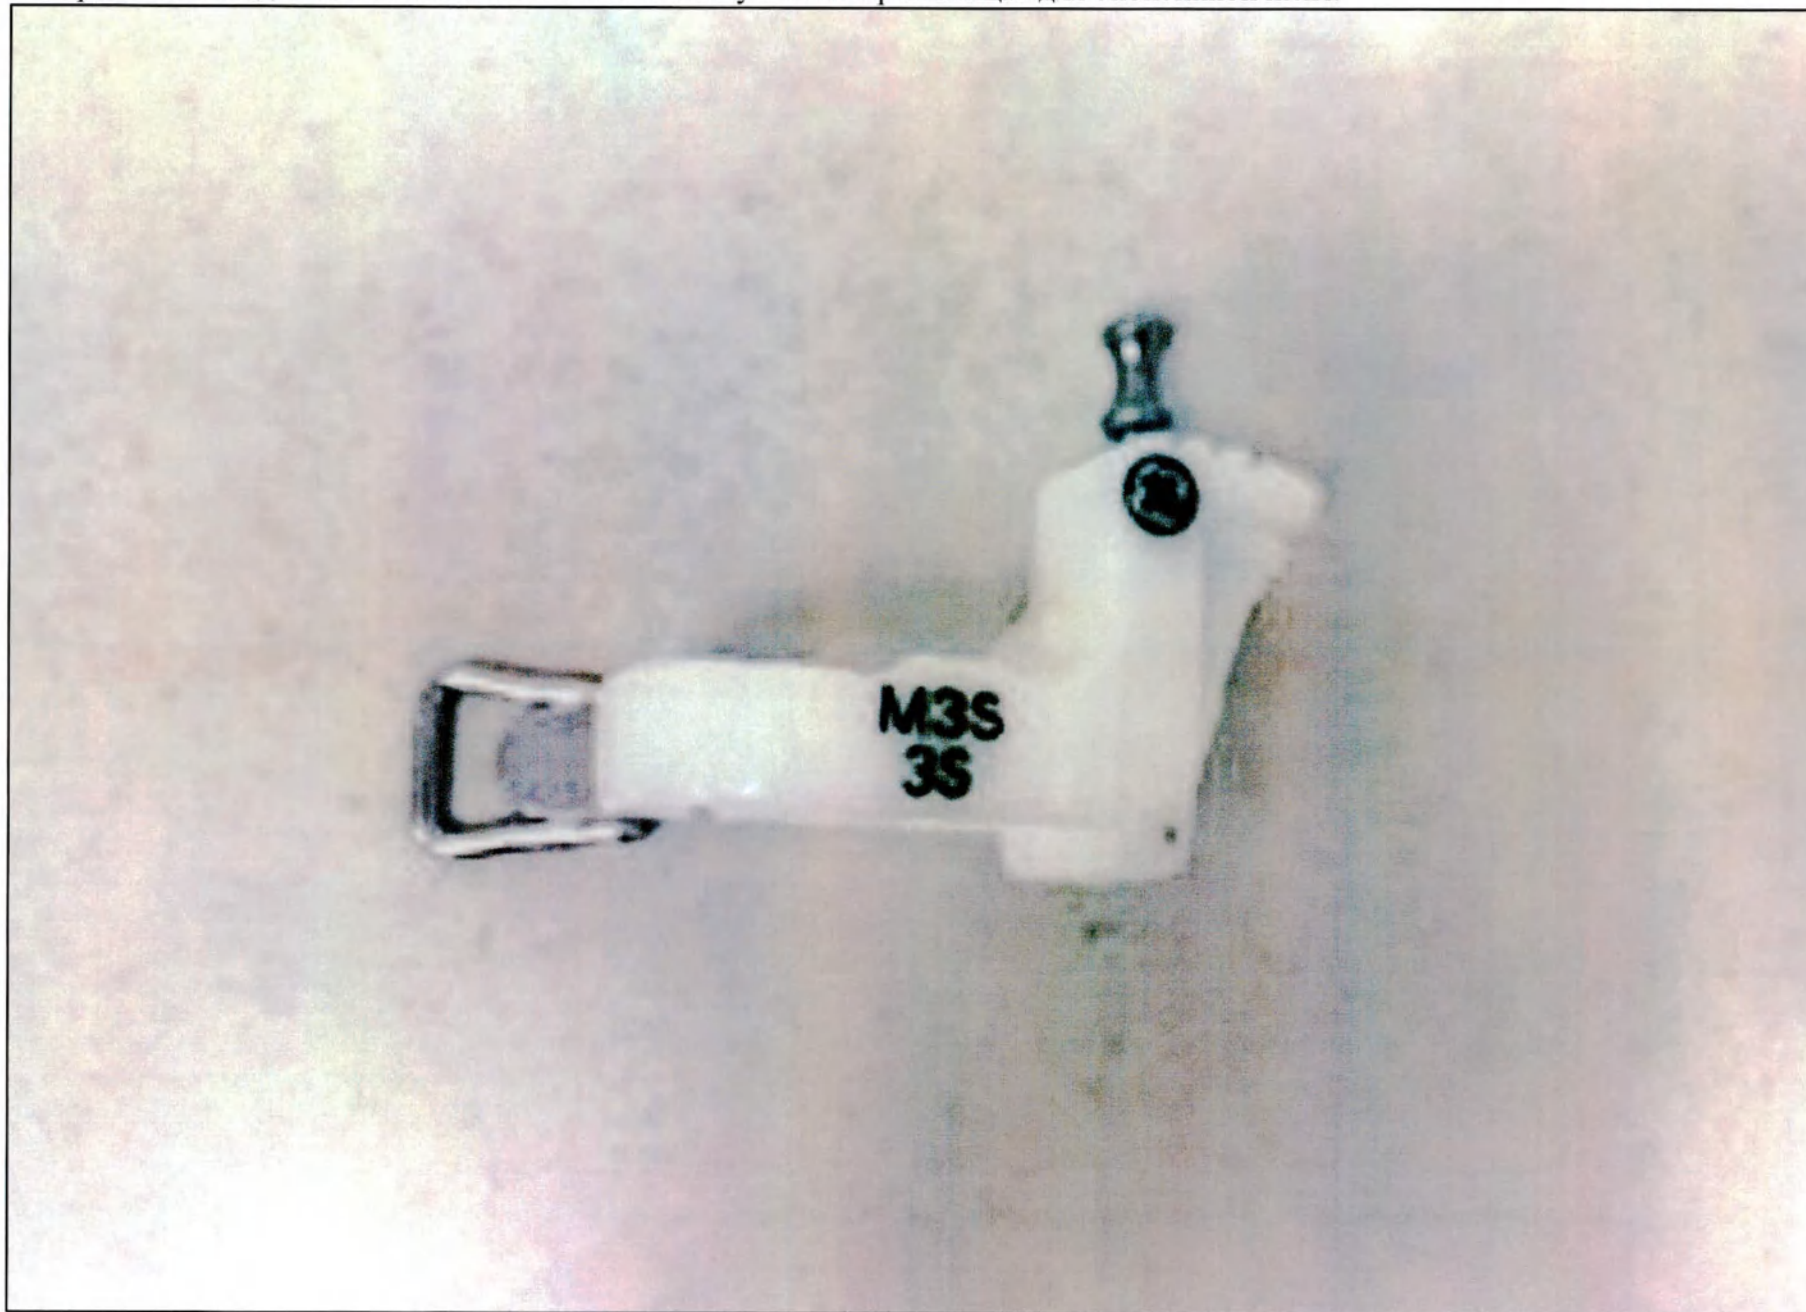


Насадки биопсийные С1-6 для конвексных датчиков.




Насадки биопсийные E8CS для конвексных специальных датчиков.



Насадки биопсийные 11L/12L для линейных датчиков.

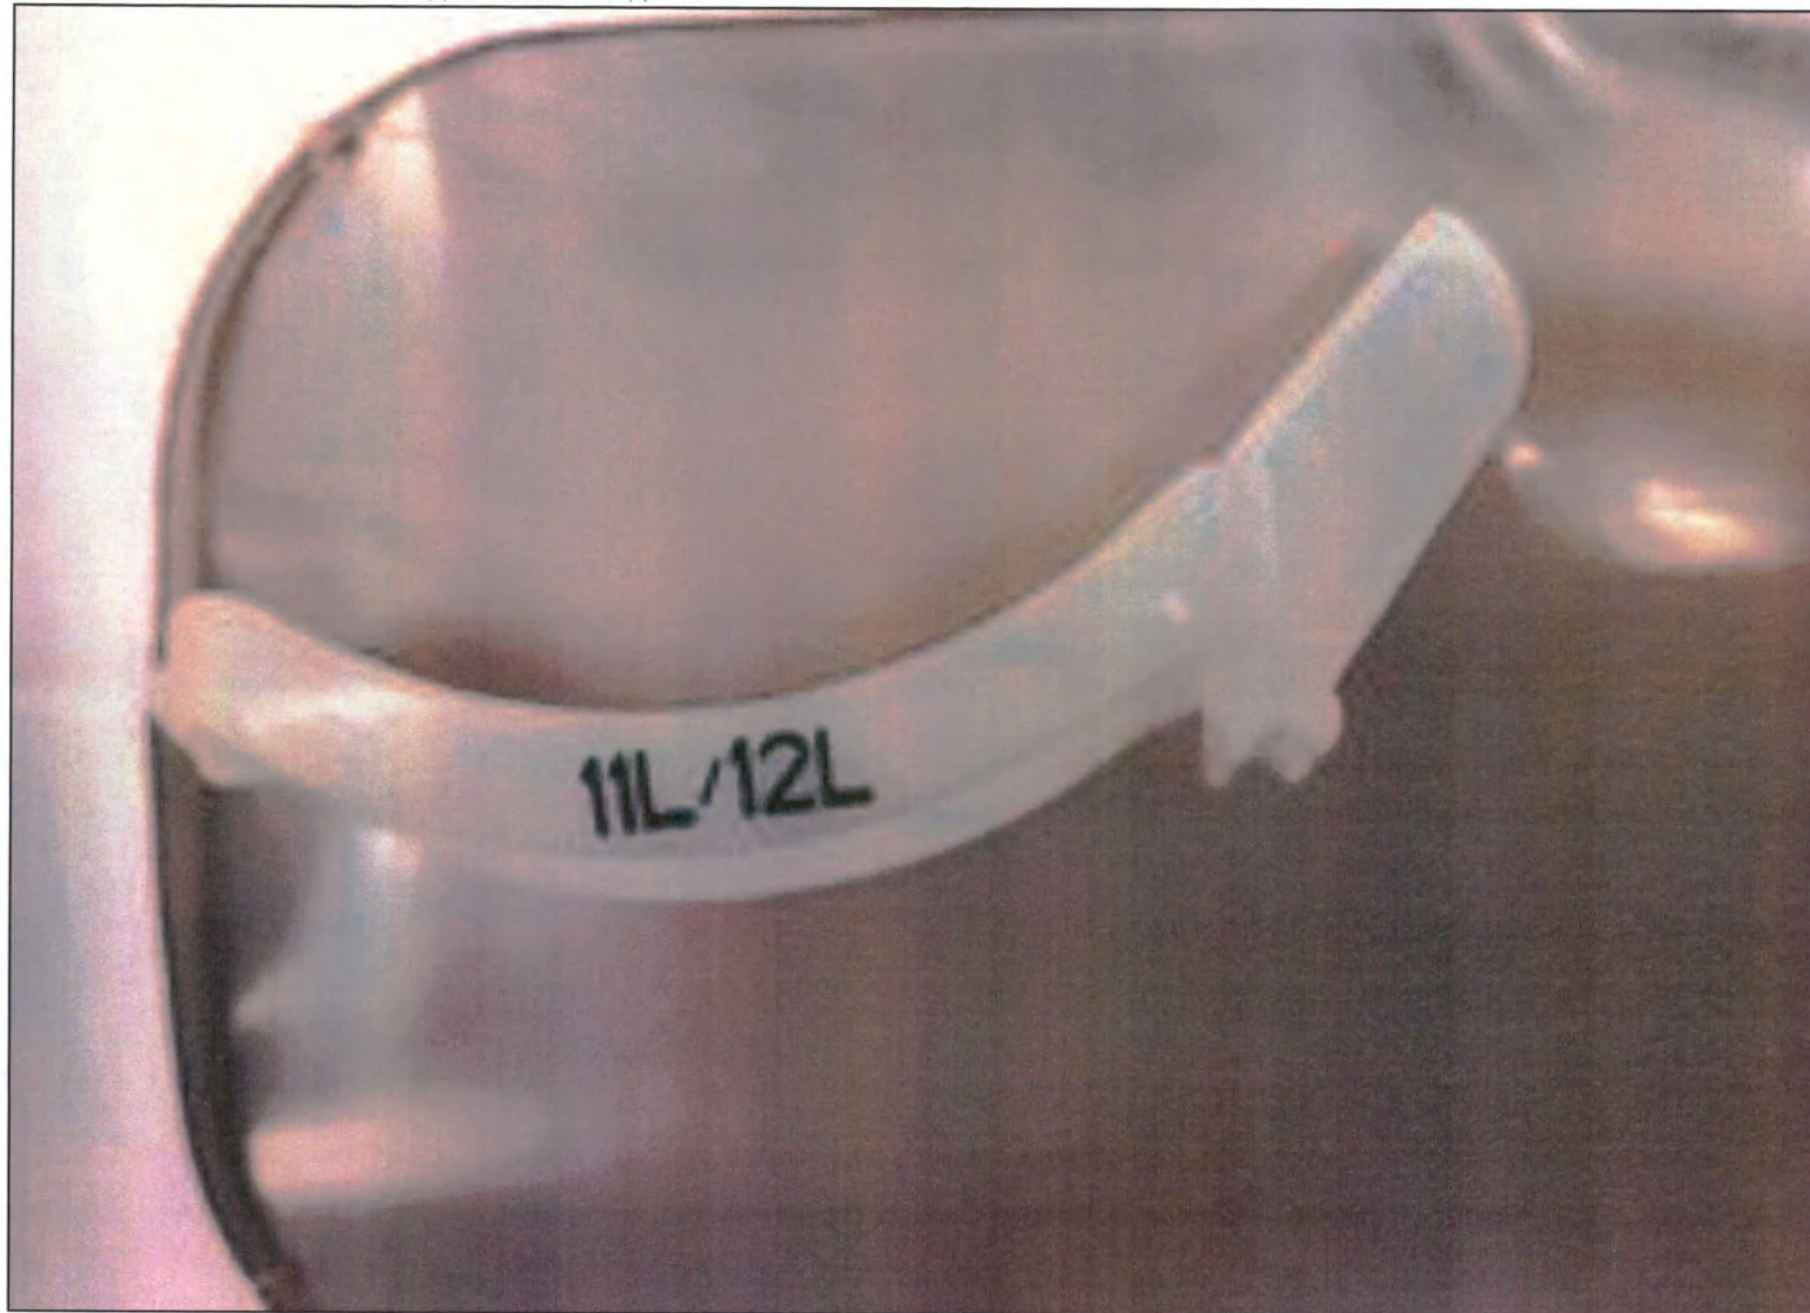

Биопсийные насадки для линейного матричного датчика ML6-15 –RS.

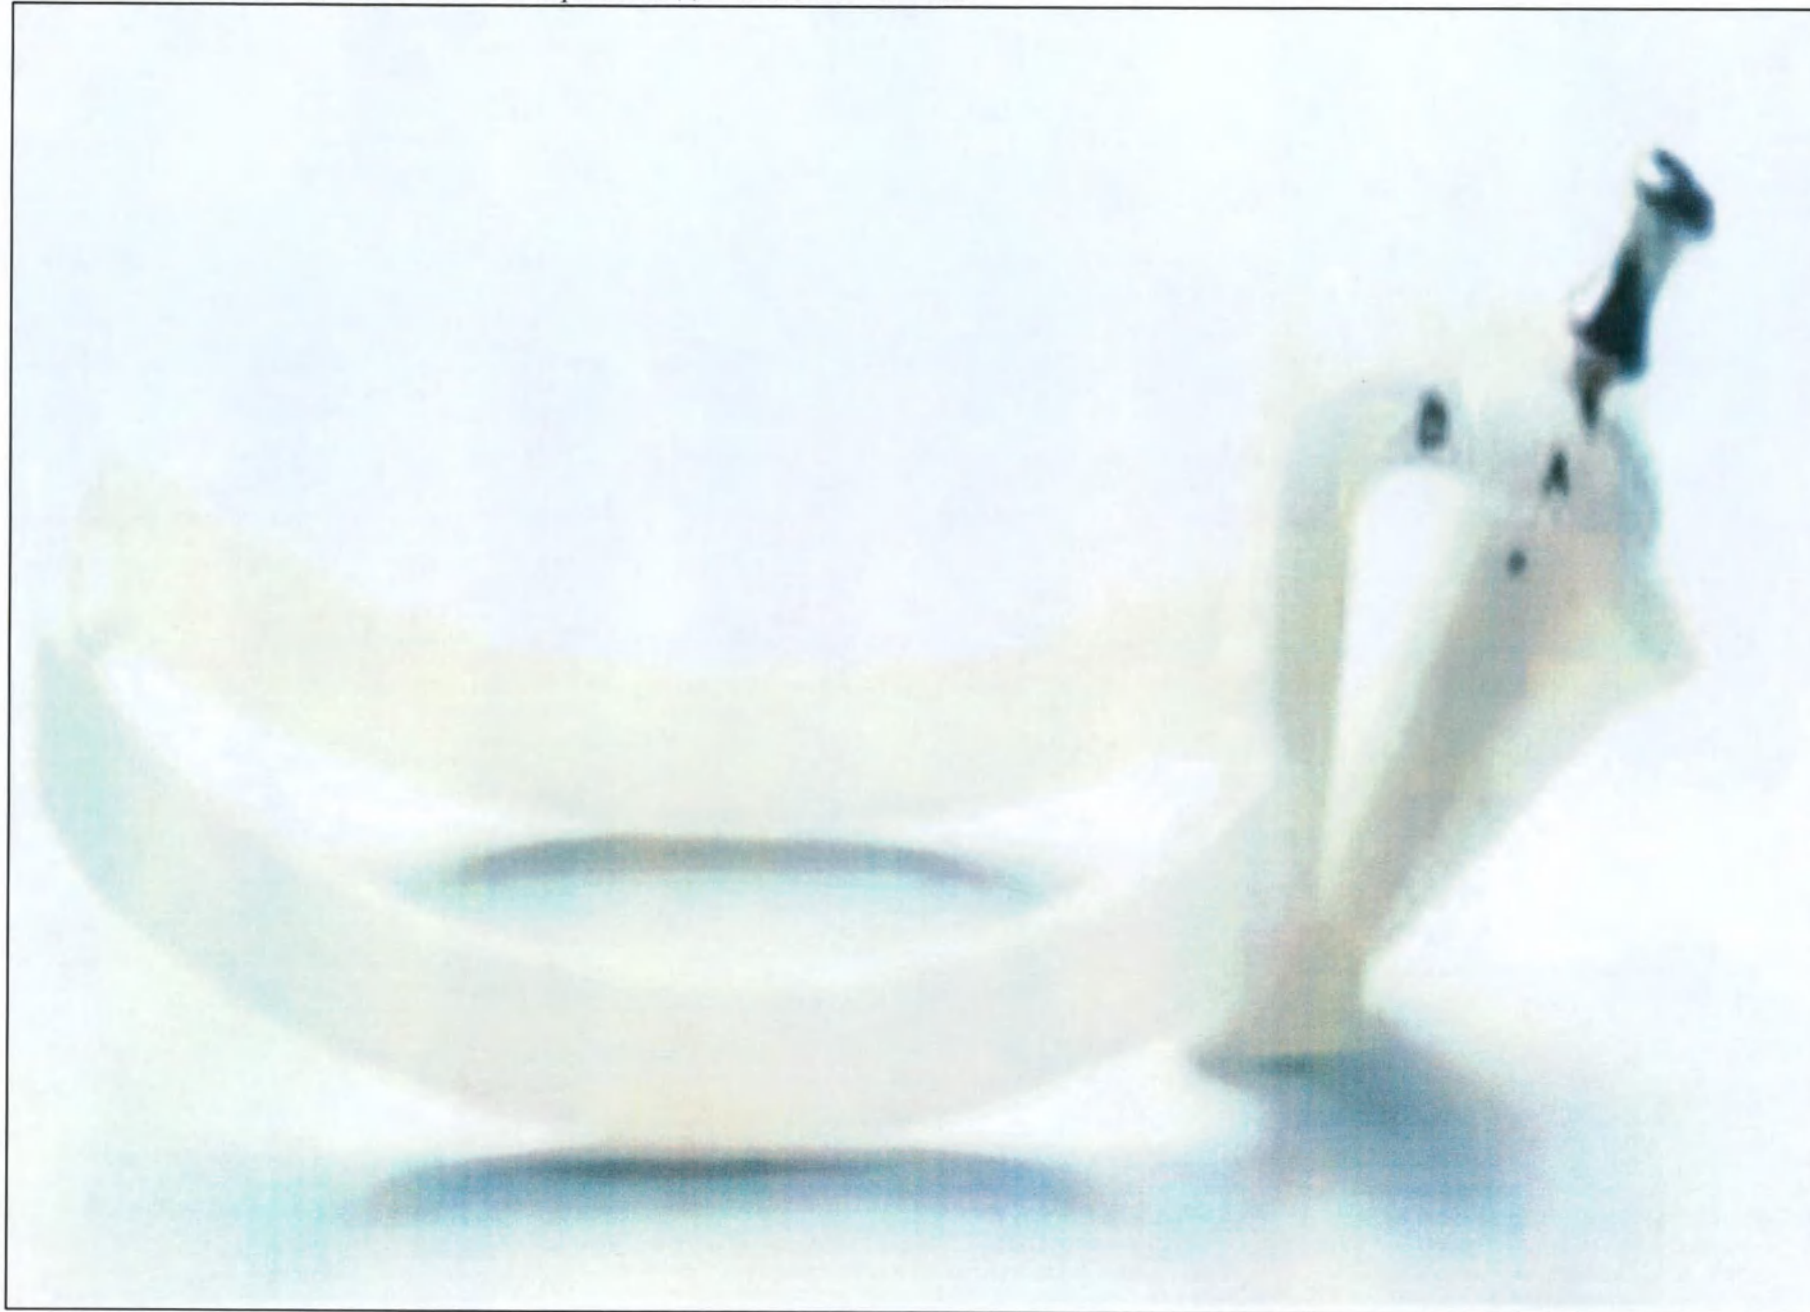

Макет маркировки для Насадки биопсийные M5S-D для секторных фазированных матричных датчиков, Насадки биопсийные 3Sp для секторных фазированных датчиков, Набор начальный для биопсии M3S/3S: биопсийный угол и направляющая для биопсийной иглы, Насадки биопсийные C1-6 для конвексных датчиков, Насадки биопсийные 11L/12L для линейных датчиков, Биопсийные насадки для линейного матричного датчика ML6-15-RS.

REF	2	4	LOT		1	
QTY	3					
5						
6						
						7 Rx ONLY
8						
9						
11  Temperature 12  13  Date of Manufacture: 14  Use By: 15  Keep away from sunlight 16  Consult instructions for use 17  18 19						
10						

Макет маркировки для Насадки биопсийные E8CS для конвексных специальных датчиков.

1  CIVCO

2 REF 4 LOT

3 QTY

5

6

7 **STERILE**
Sterilization using ethylene oxide
Rx ONLY

8

9

10

11

12 

13 Date of Manufacture:

14 Use By:

15  Keep away from sunlight

16  Consult instructions for use

17

18

19

20 **STERILE**
Sterilization using ethylene oxide

21

22  Do not use if package is damaged

23  Do not reuse

24

Устройства для хранения чреспищеводных датчиков.



Макет маркировки для Модуль регистрации физиологических сигналов, Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента, Коннектор для подключения внутрисердечного датчика с ферритовым фильтром, Подставка для системы Vivid IQ, Устройства для хранения чреспищеводных датчиков, Внешний жесткий USB диск для хранения цифровой информации, Фильтр ферритовый для подключения внутрисердечного датчика.

1

HCAT #: 2

Desc: 3

4

5

Защитные загубники взрослые многоразовые Gastroguard.



Макет маркировки Защитные загубники взрослые многоцветные Gastroguard.


1	2	17	CE		
REF	3	P/N	4	Cat#	5
MD	7	!	8	NON HYPER	
Exp. Date:	9	QTY:	10		
Storage:	11	18	12		
13	Date of Manufacture:	UDI-DI:	14		
LOT	15				
16					

(422)5902596226060 (11)210504


Защитные загубники взрослые одноразовые Escoguard.



Защитные загубники детские.

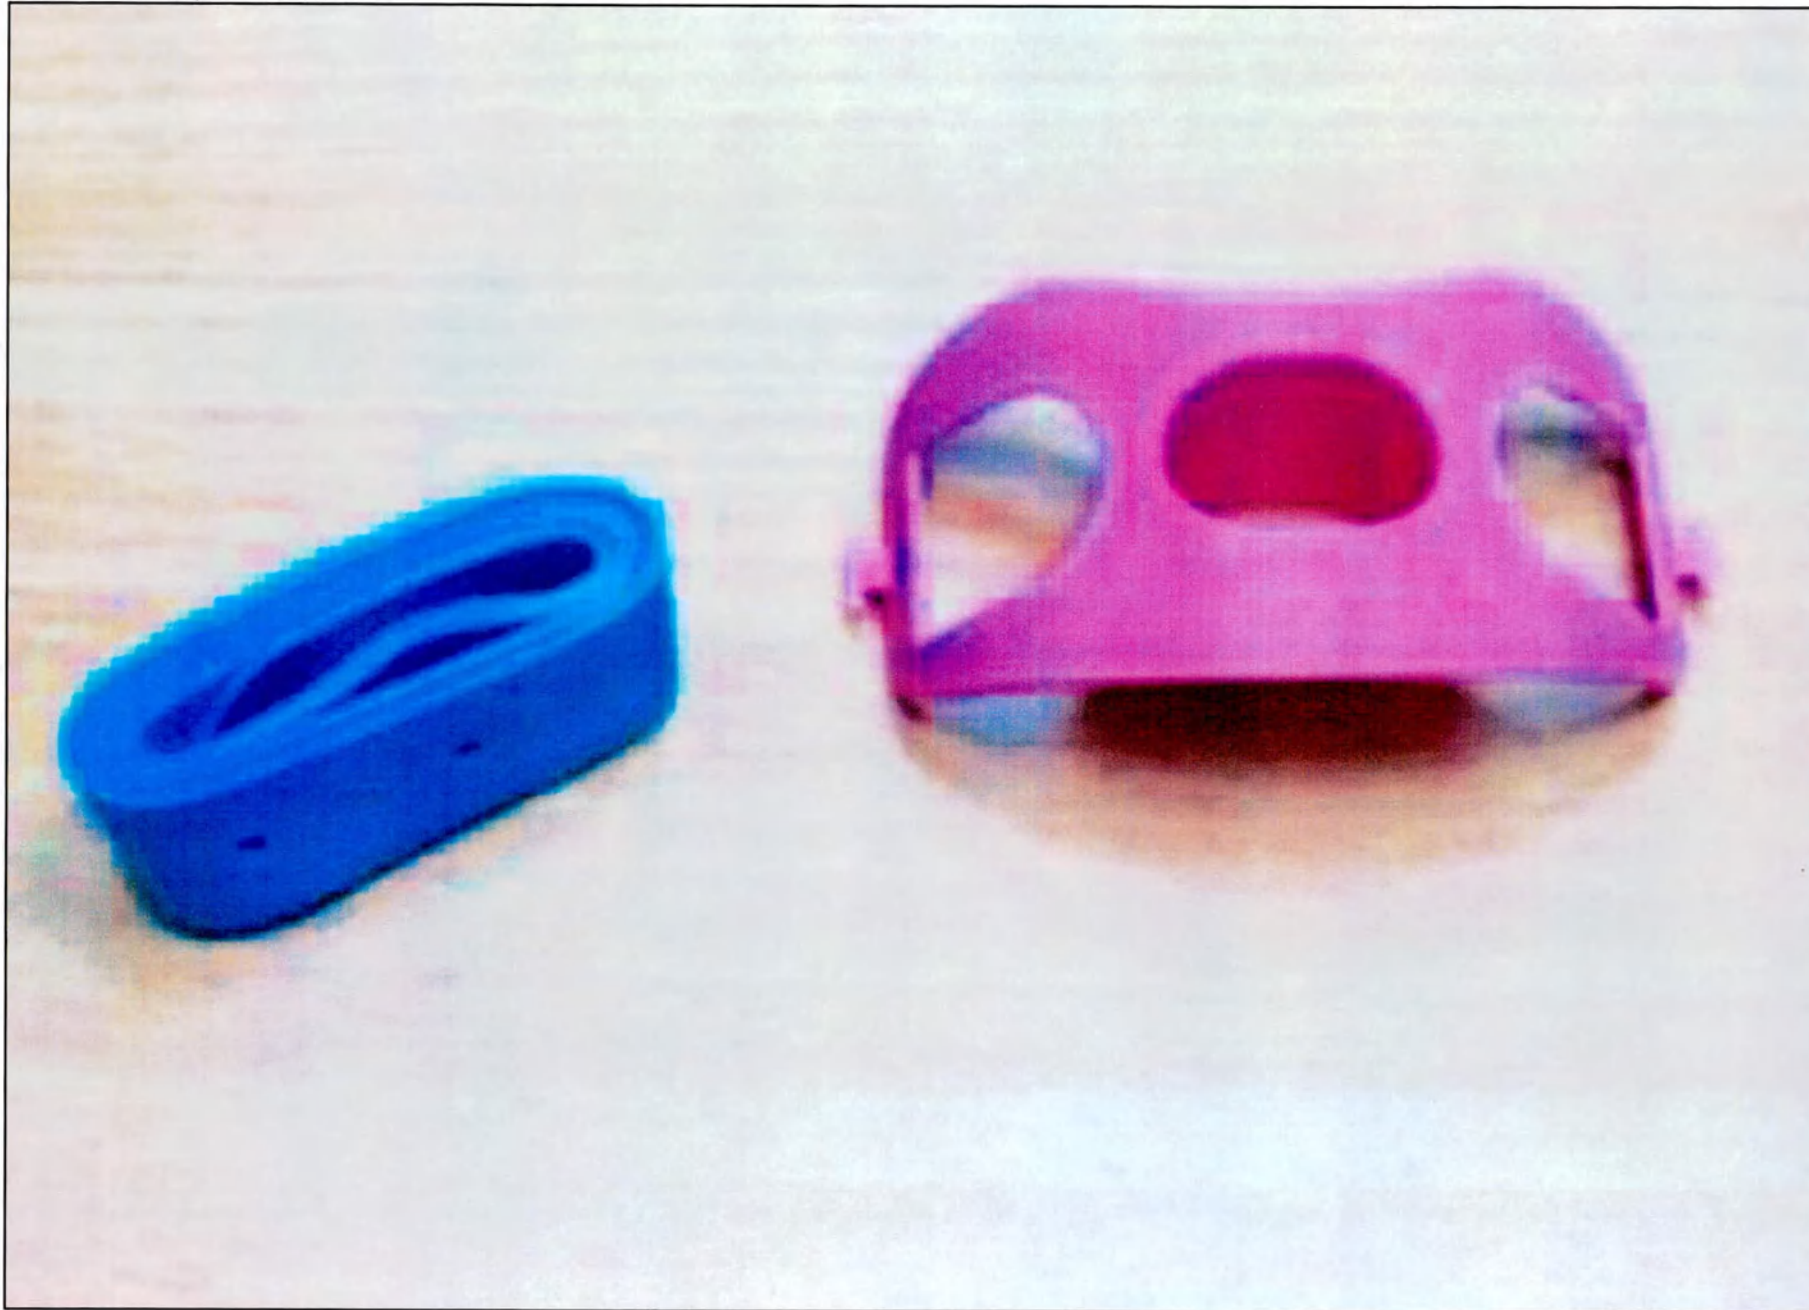

Защитные загубники интраоперационные.

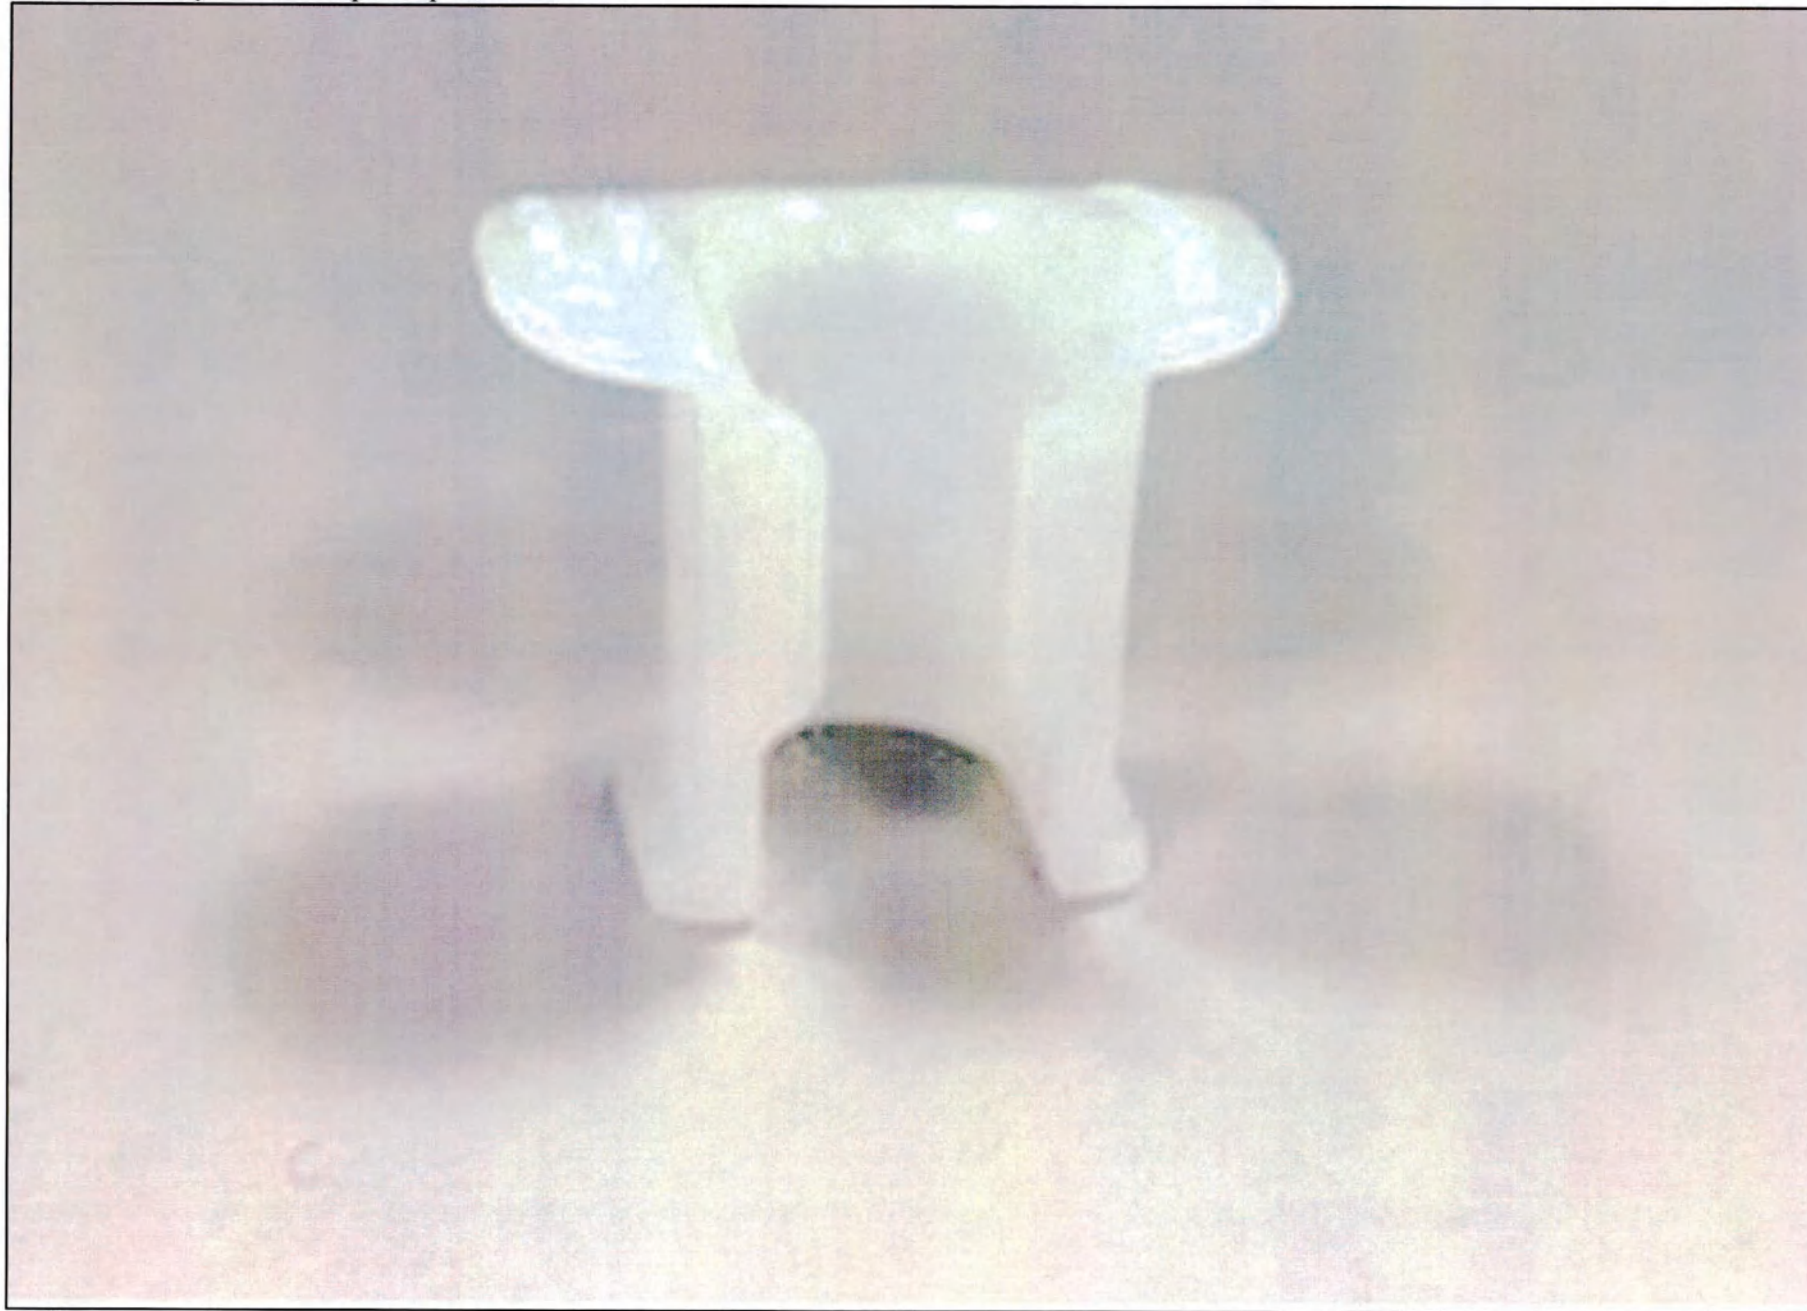

Макет маркировки для Защитные загубники взрослые одноразовые Esguard, Защитные загубники детские, Защитные загубники интраоперационные.

1 [] 2 [] 17 CE

REF 3 [] P/N 4 [] Cat# 5 []

6 2 7 ! 8 NOM

Exp. Date: 9 [] QTY: 10 []

Storage: 11 [] 18 [] 12 []

13 [] Date of Manufacture: UDI-DI: 14 []

LOT 15 []

16 []

(422)5902596226060 (11)210504


Защита головки для взрослого чреспищеводного датчика.



Защита головки для детского чреспищеводного датчика.




Устройство для контроля повреждений чреспищеводных датчиков.

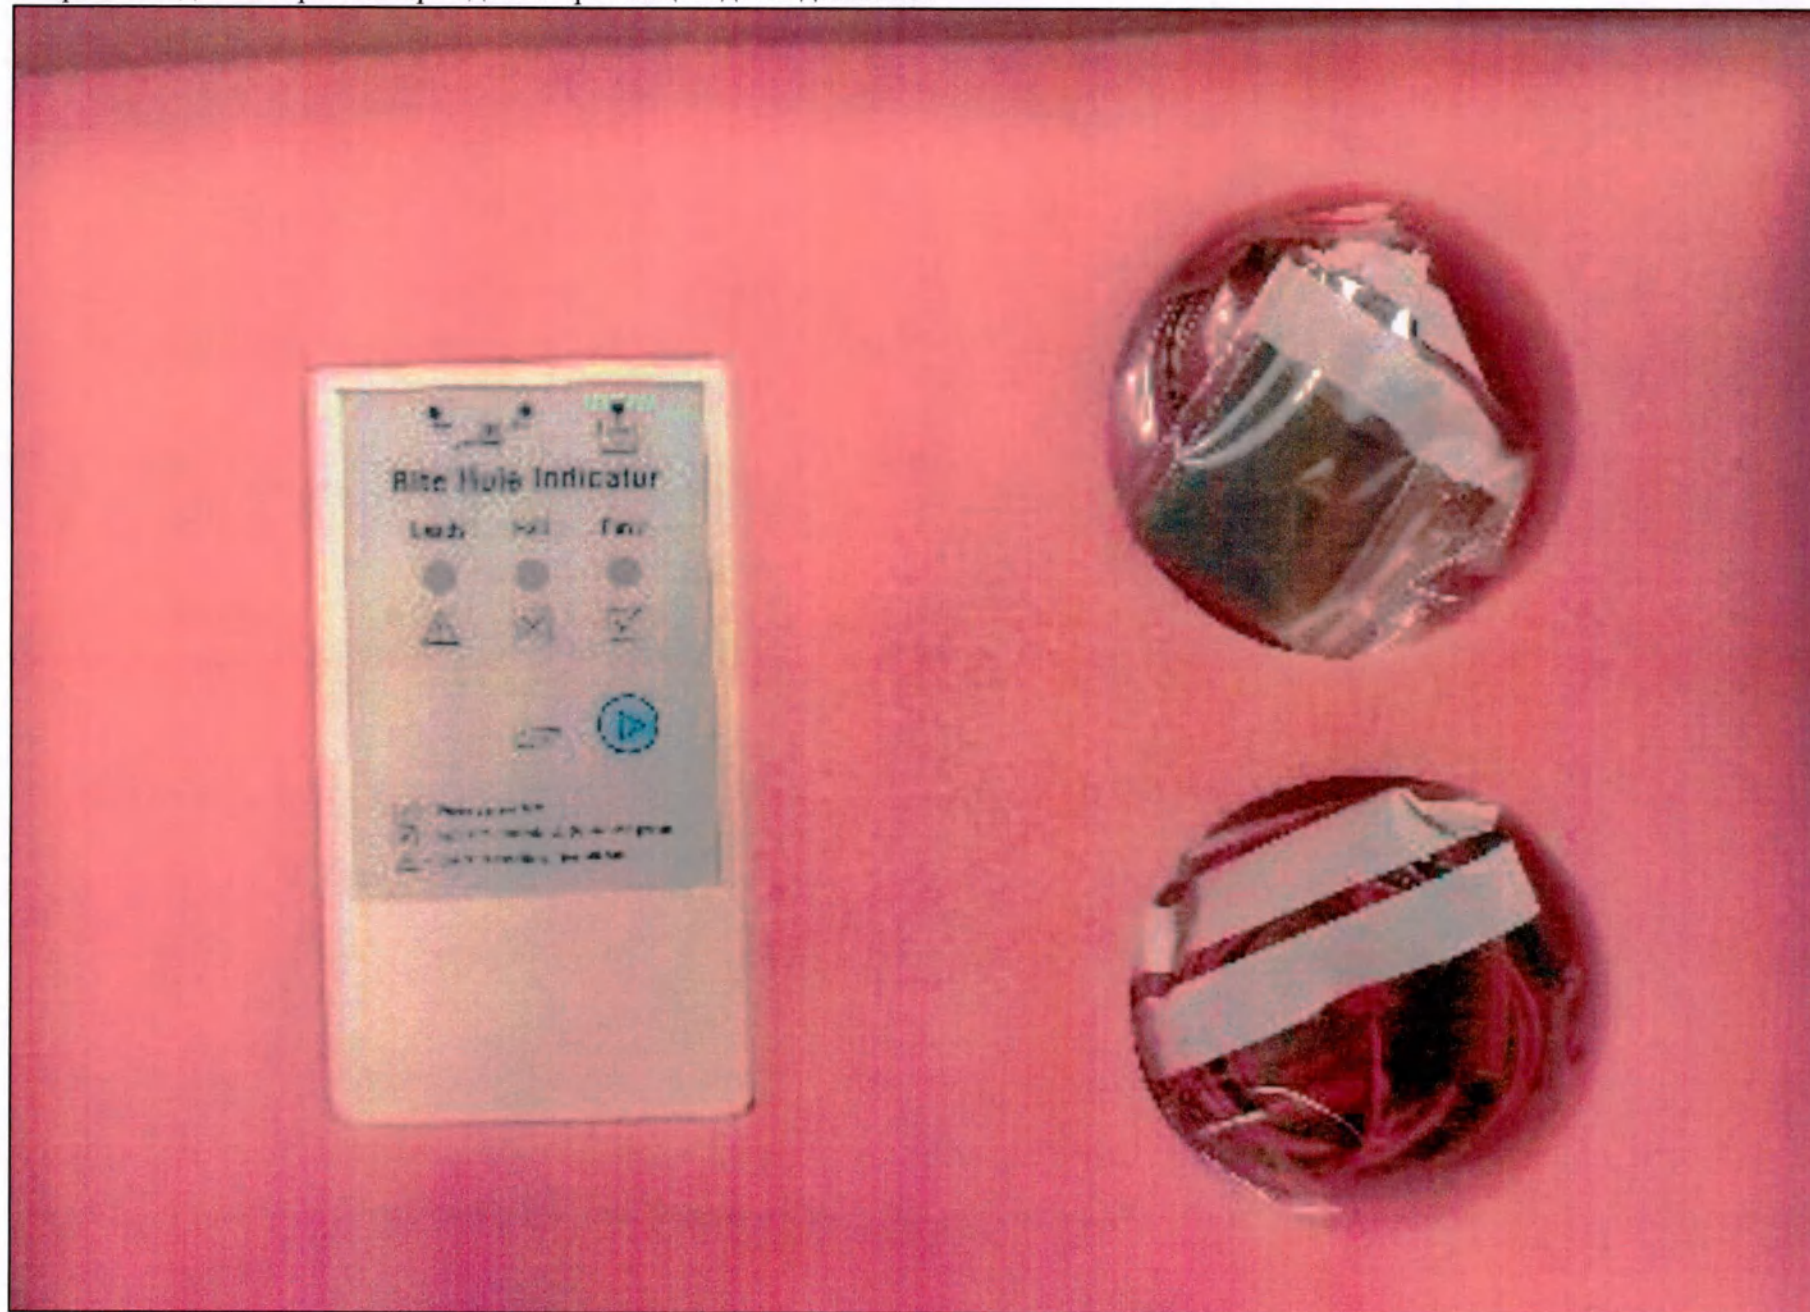

Макет маркировки Устройство для контроля повреждений чреспищеводных датчиков.

1  GE Medical Systems	7
P/N: 8 V nom: 10 S/N: 9 I max: 11 Manufacturer: 12	2  3  4  5  6  C US


Инструкция по эксплуатации чреспищеводных датчиков и принадлежностей к ним.

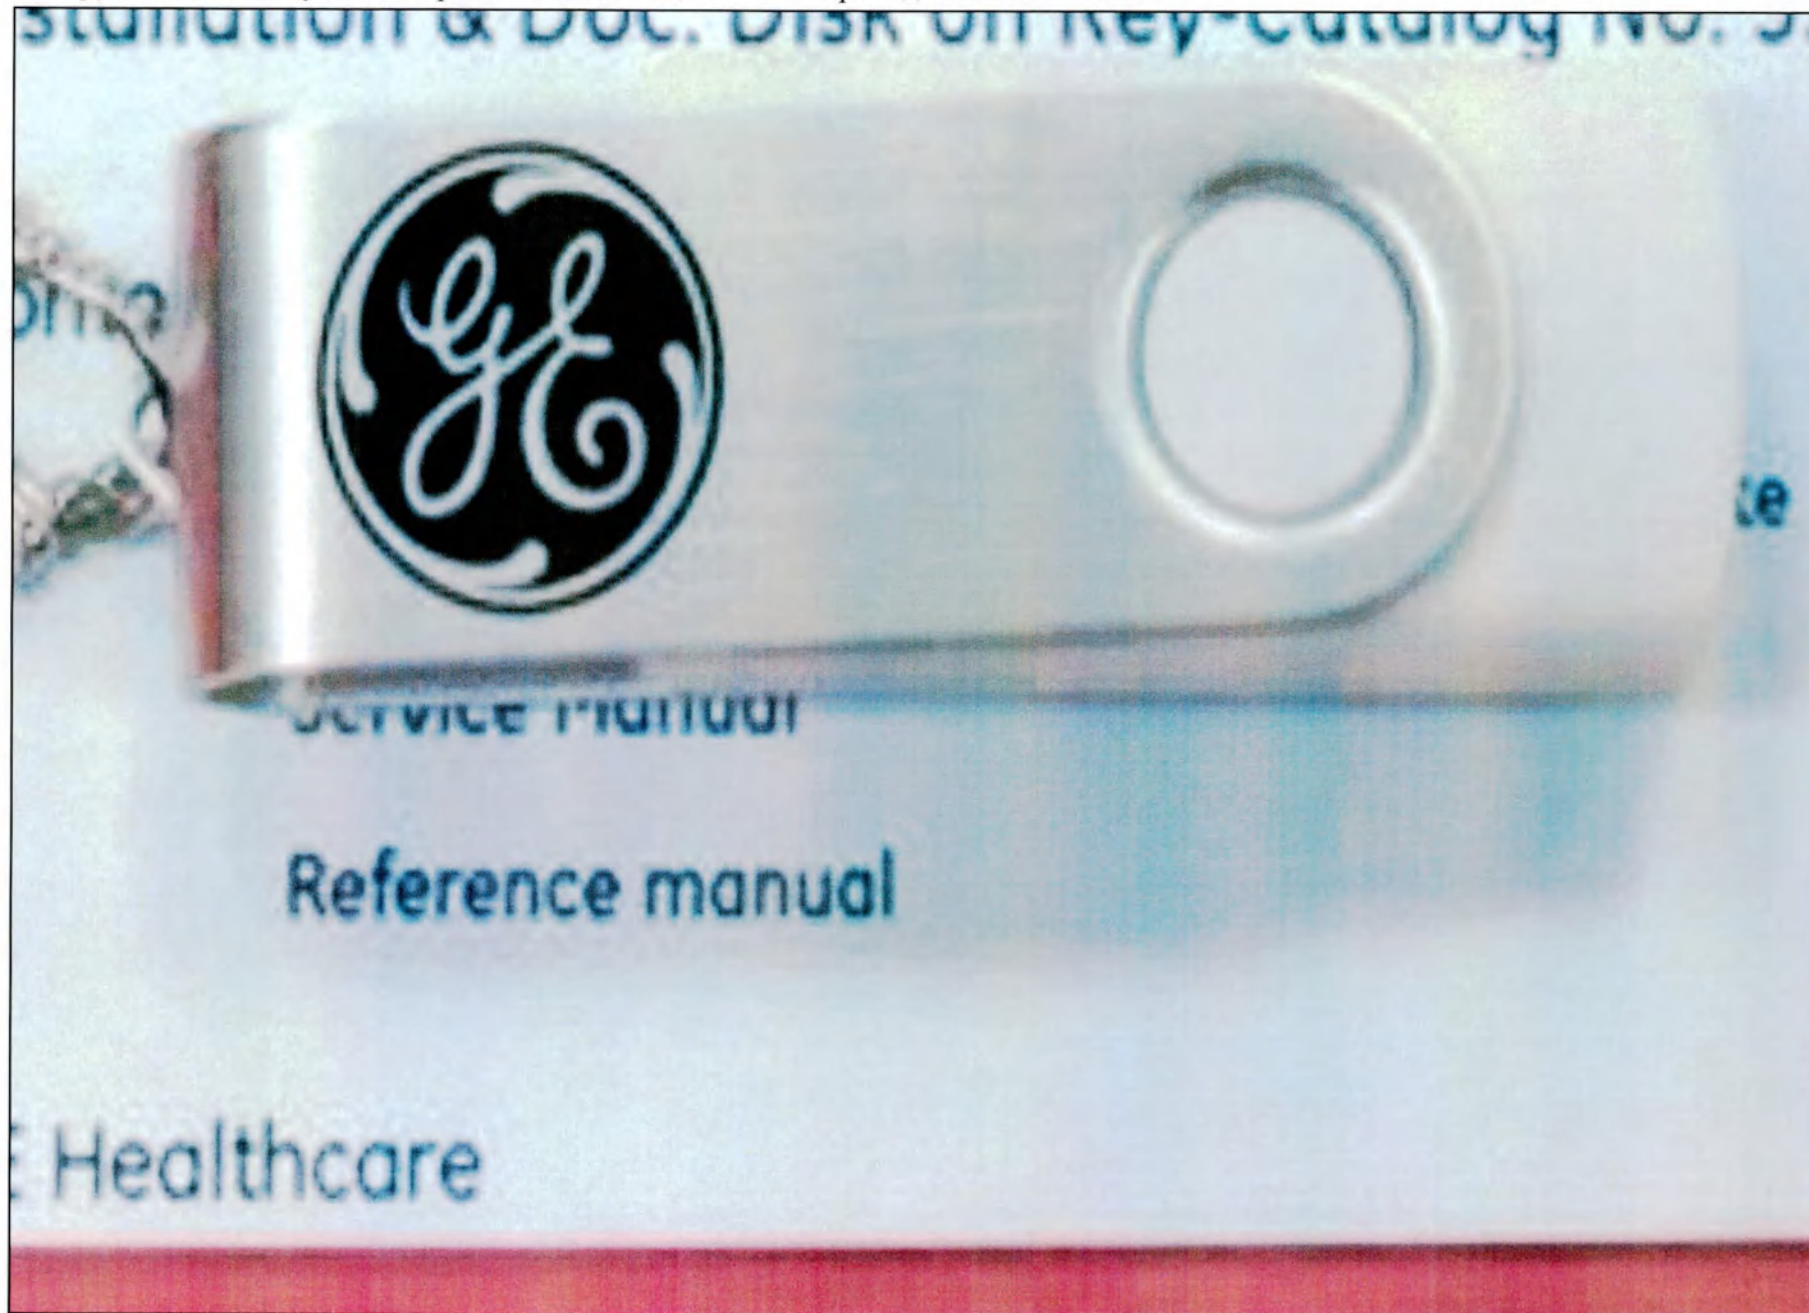

Модуль регистрации физиологических сигналов.




Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента.

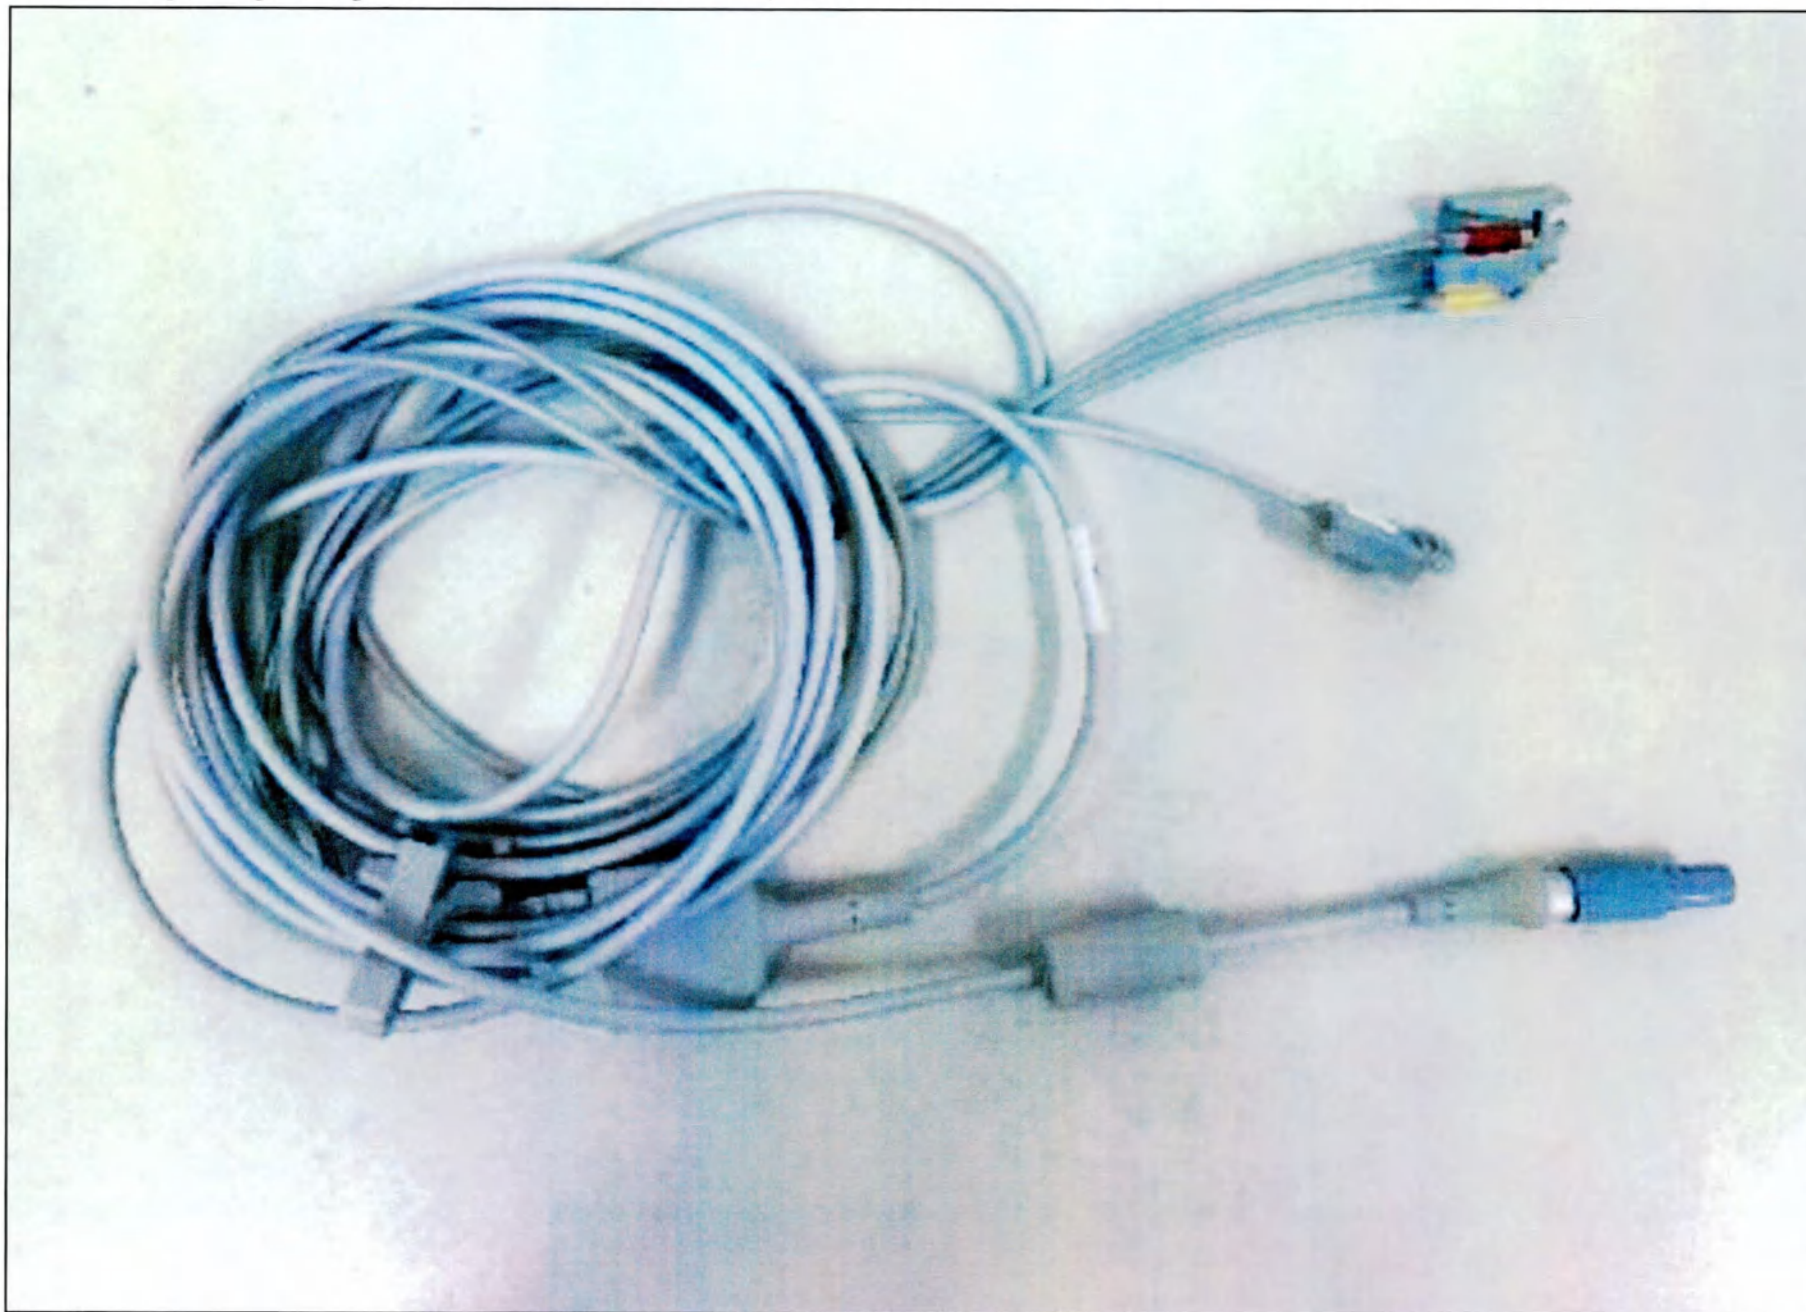


Кабель для подключения внешних источников физиологических сигналов.



Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента детский.

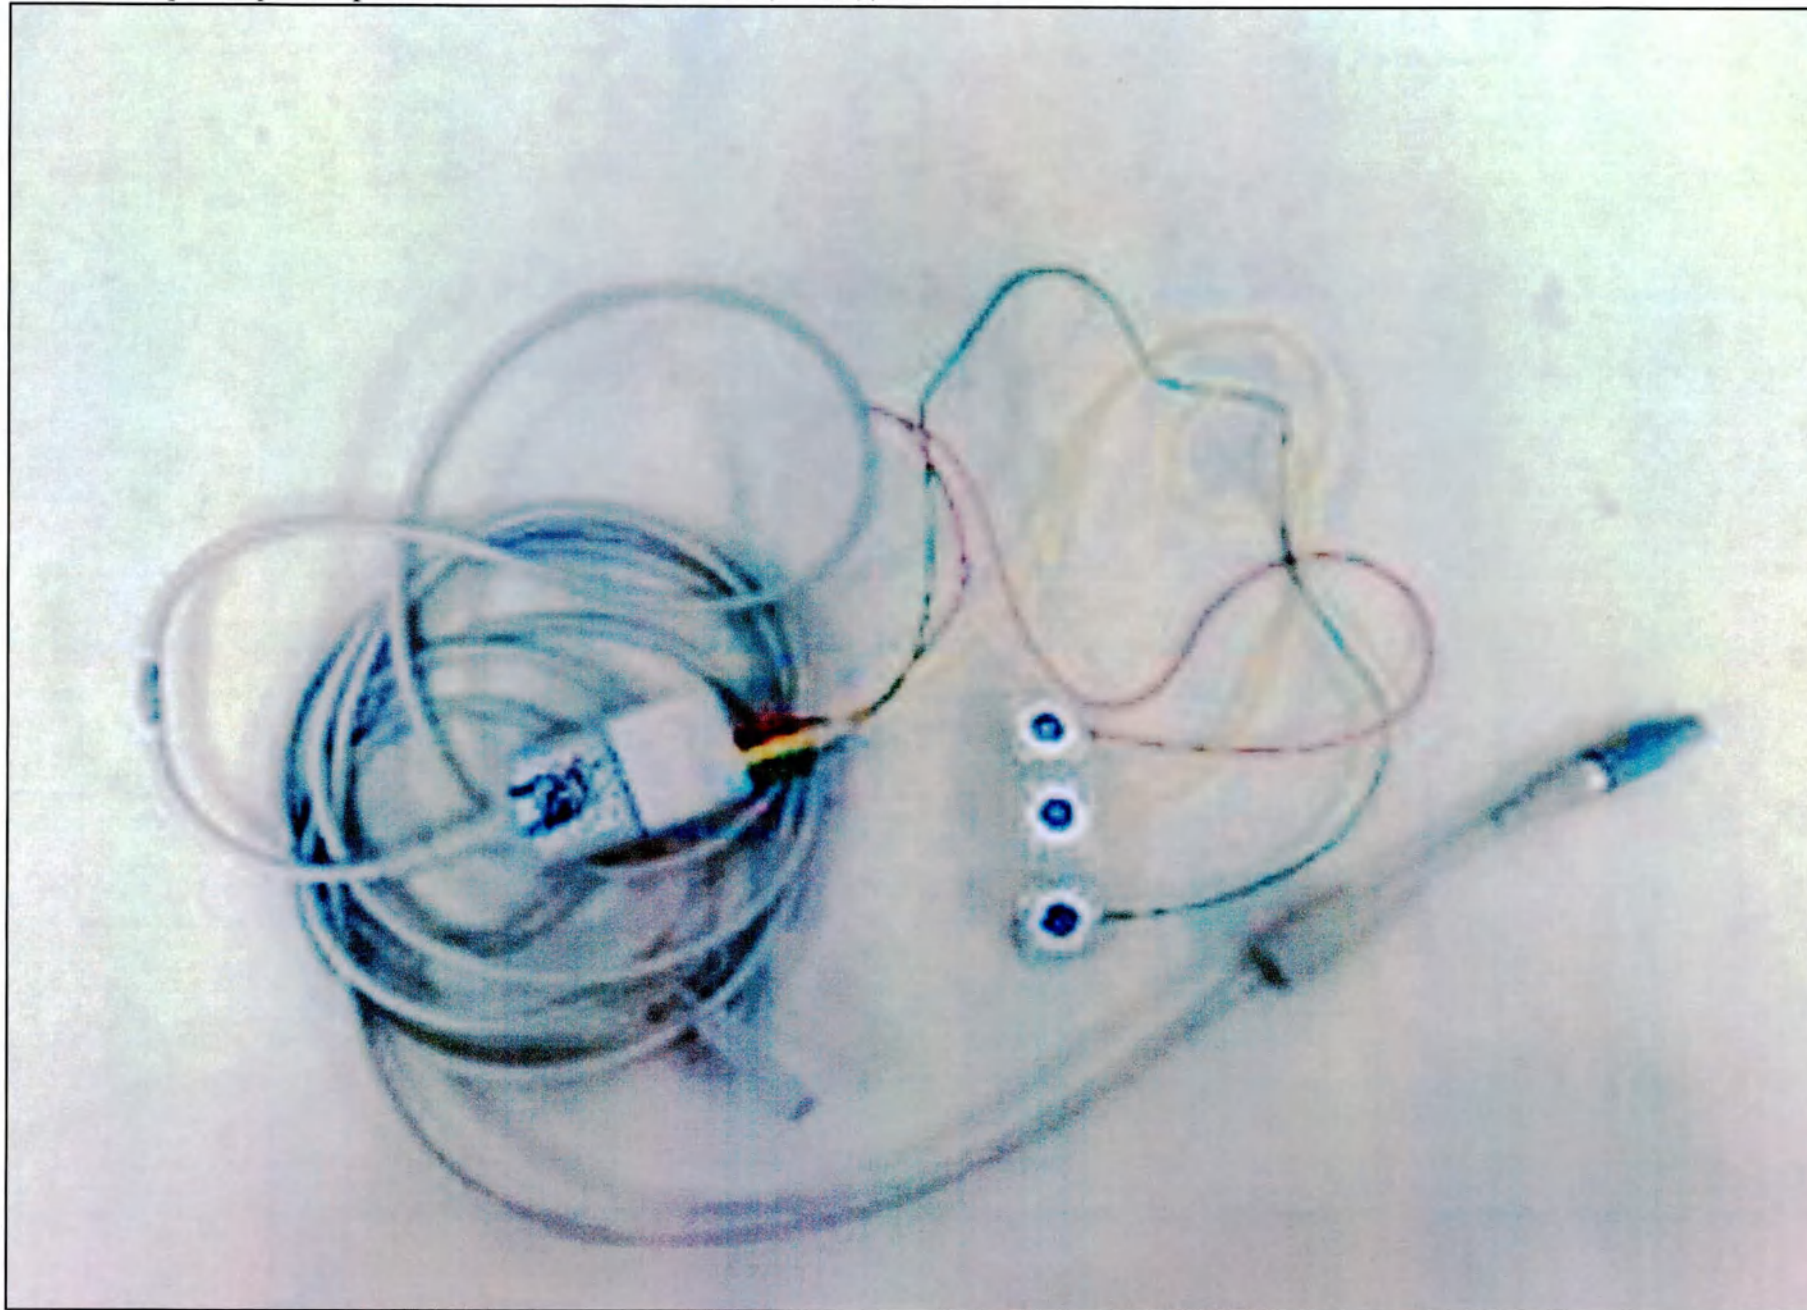

Коннектор для подключения детских ЭКГ электродов.

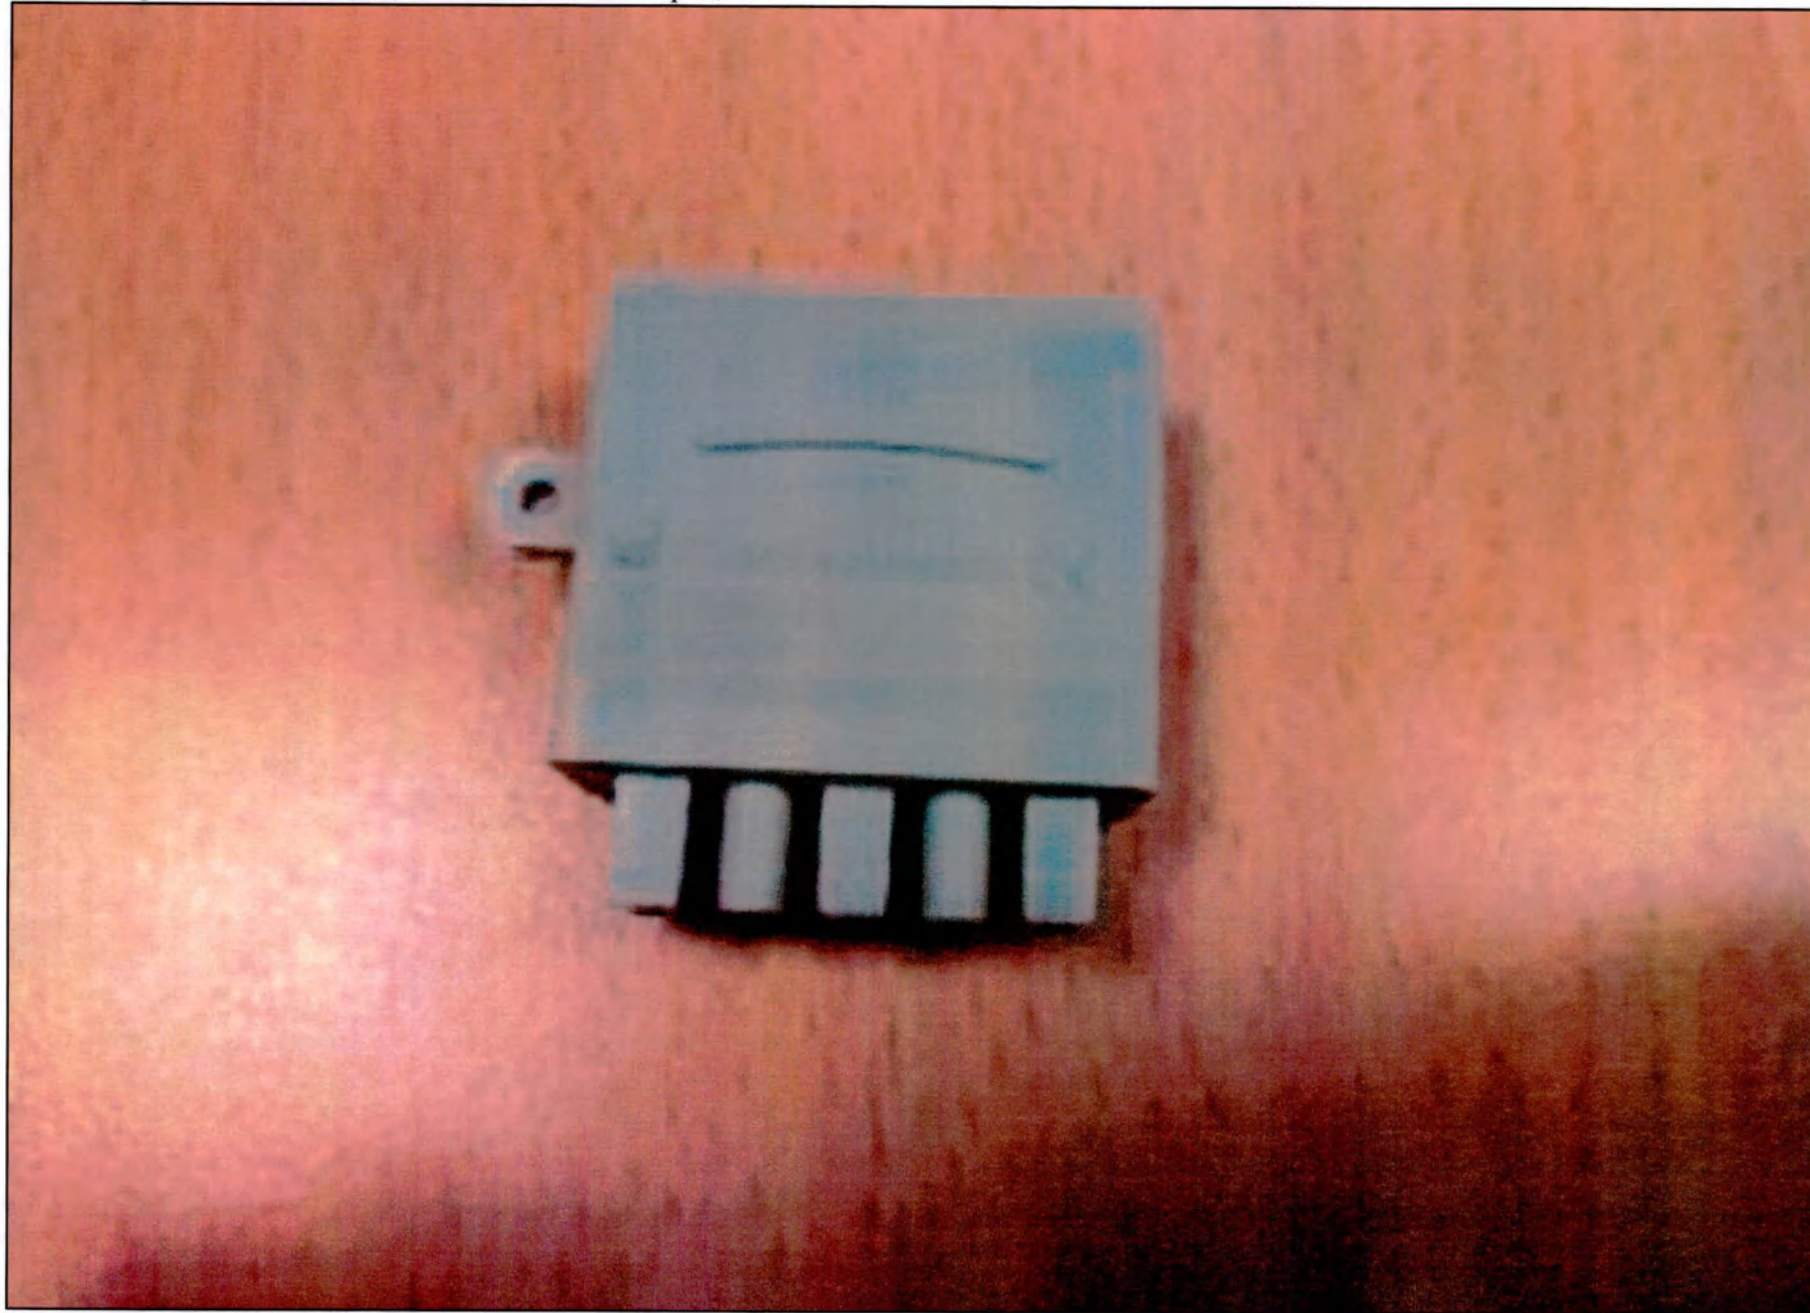

Макет маркировки Адаптер для подключения кабеля для регистрации физиологических сигналов пациента.



Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей.




Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, для взрослых и детей.



Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ у новорожденных и детей.



Адаптер для подключения модуля, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов к набору детских ЭКГ-кабелей

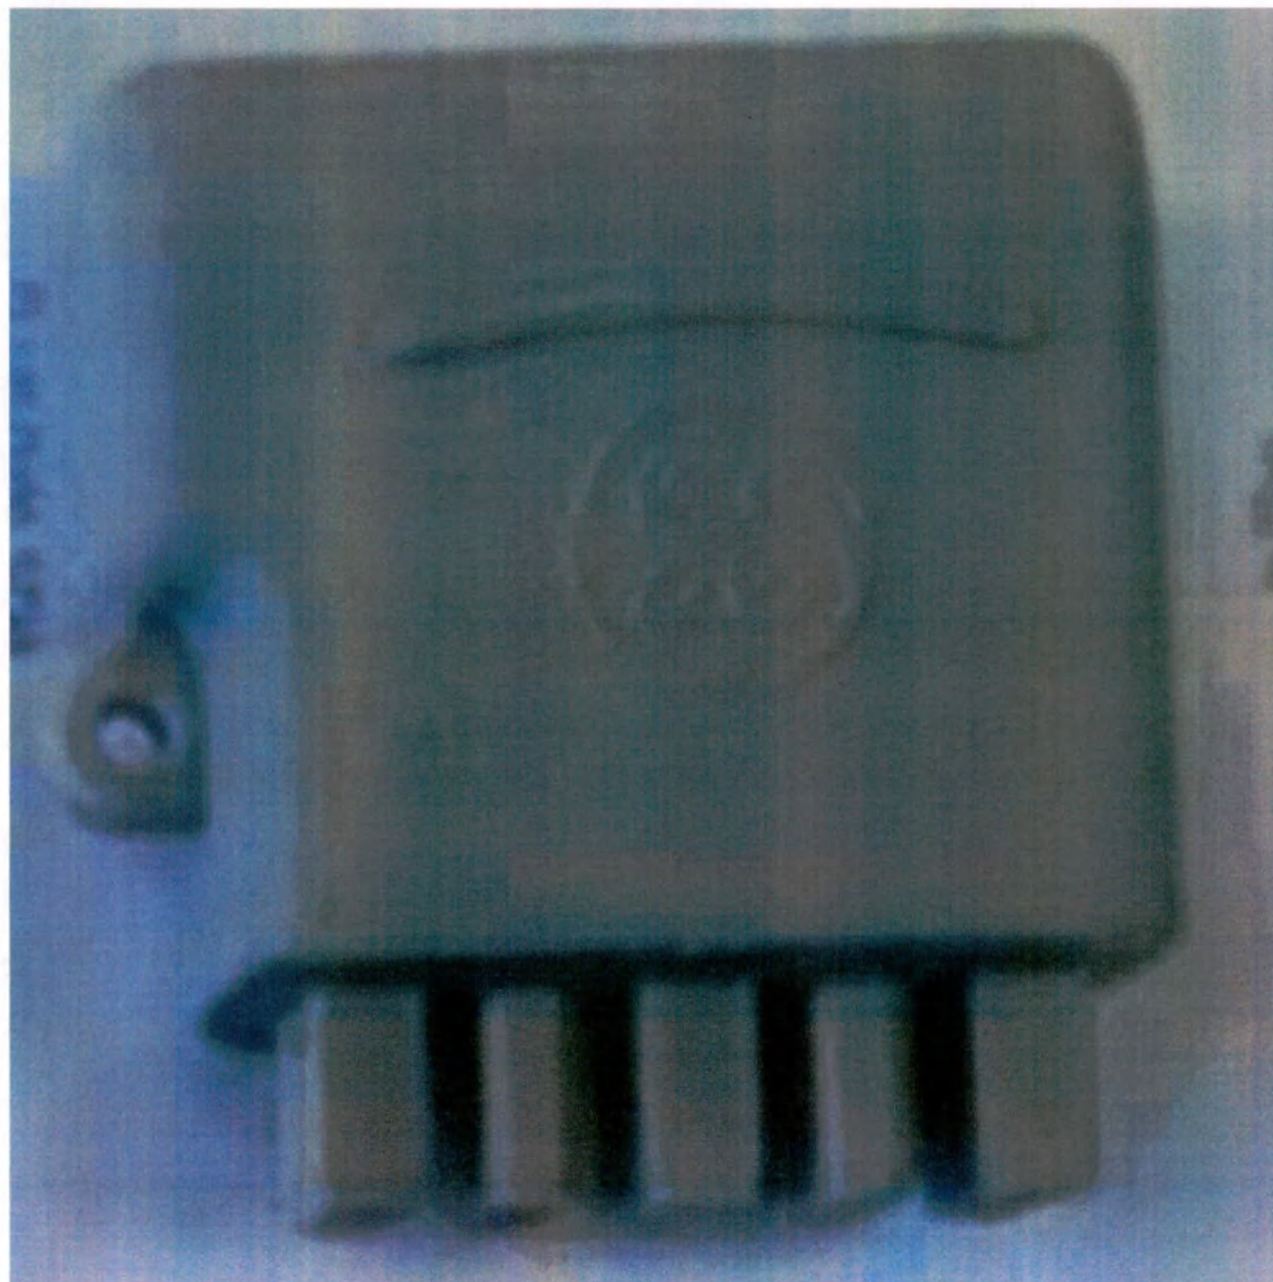

Макет маркировки для Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ для взрослых и детей, Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов в 3 отведениях, для взрослых и детей, Кабели для регистрации физиологических сигналов ЭКГ у новорожденных и детей, Адаптер для подключения модуля, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов к набору детских ЭКГ-кабелей, Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента детский, Коннектор для подключения детских ЭКГ электродов.

1

2

3 REF

4 LOT

5 UDI

(01)00840682137799(10)200707F

6

7

8

9

10

11

12 IP


13 Rx Only U.S.

14


15

2107122-001 rev A


Коннектор для подключения внутрисердечного датчика.

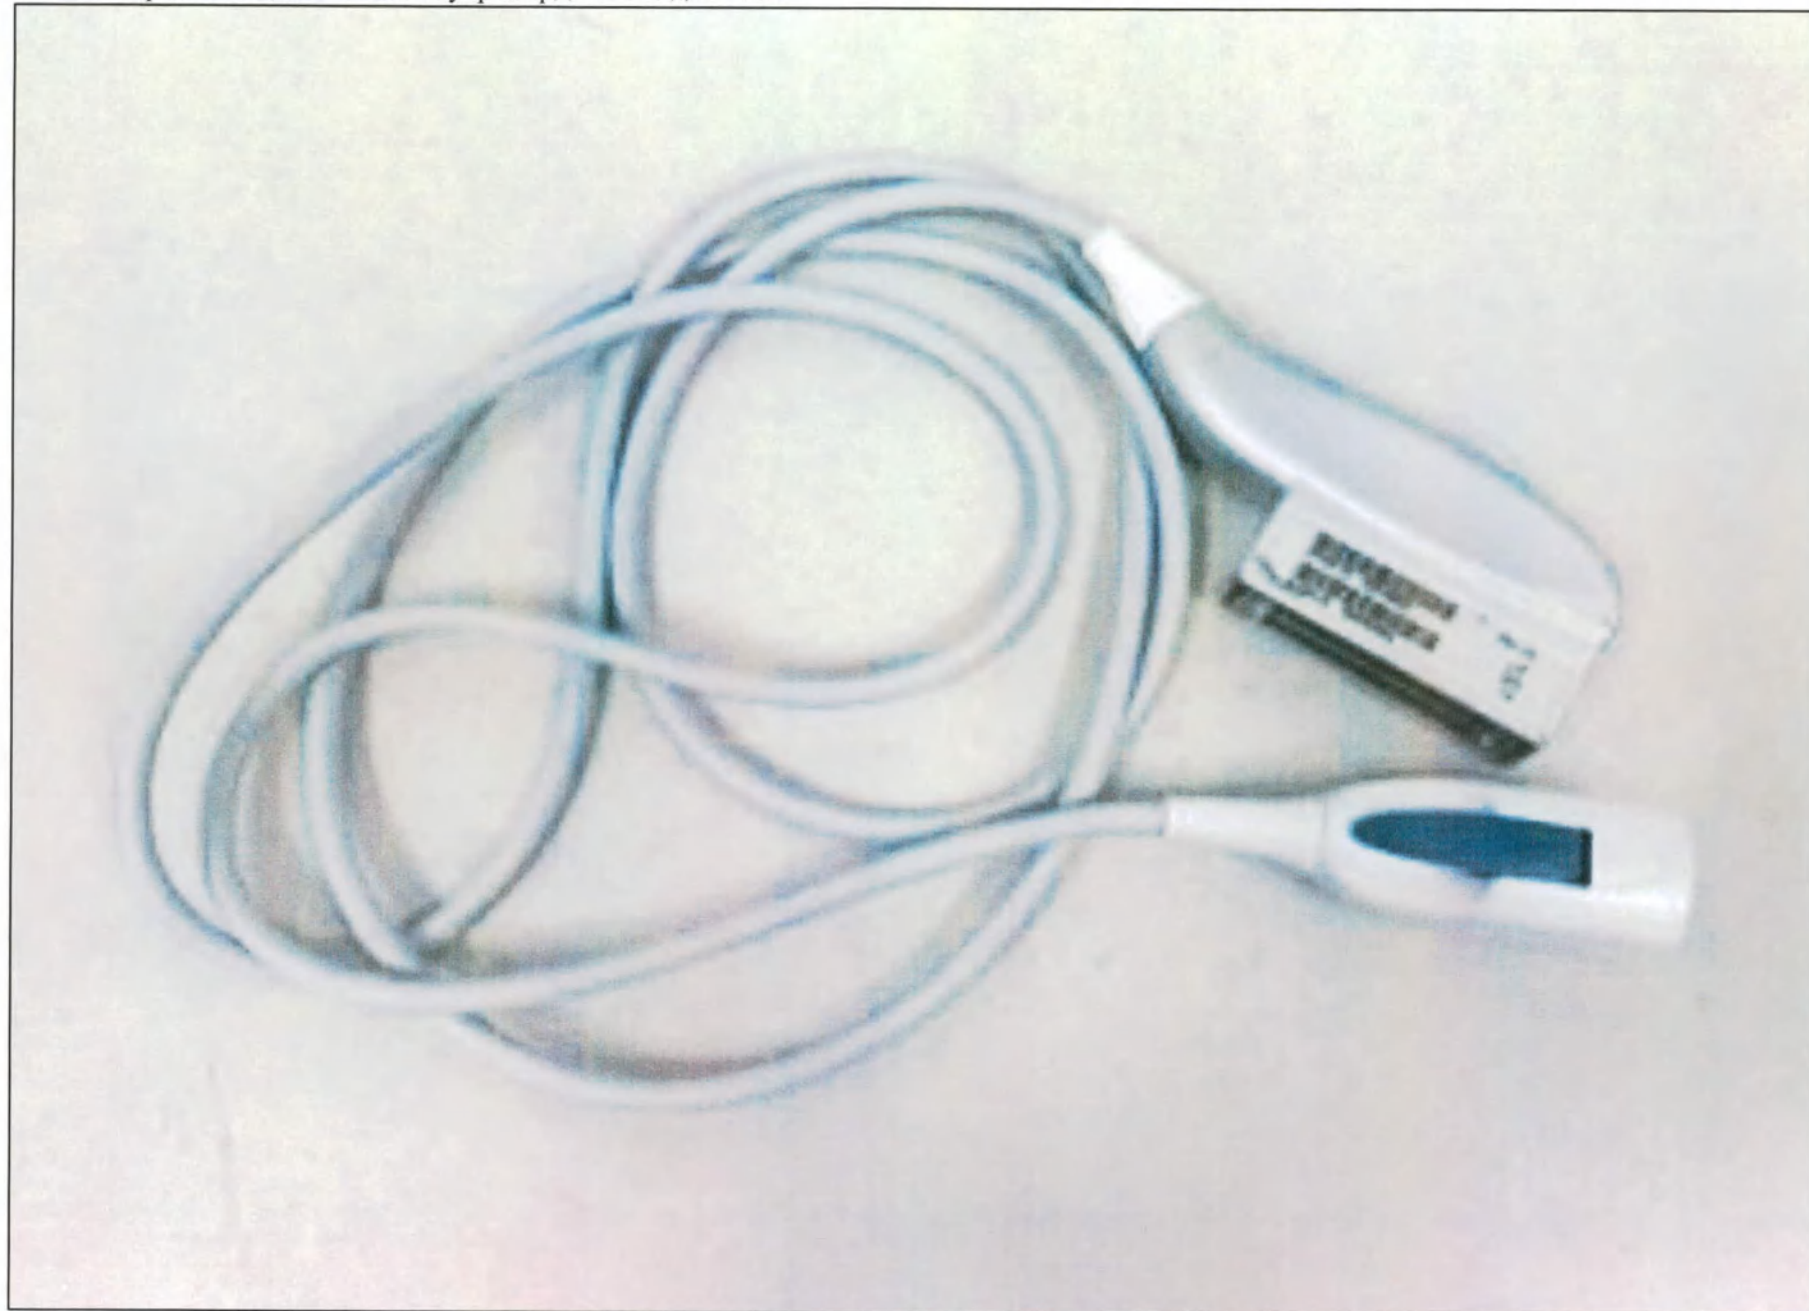


Фильтр ферритовый для подключения внутрисердечного датчика.

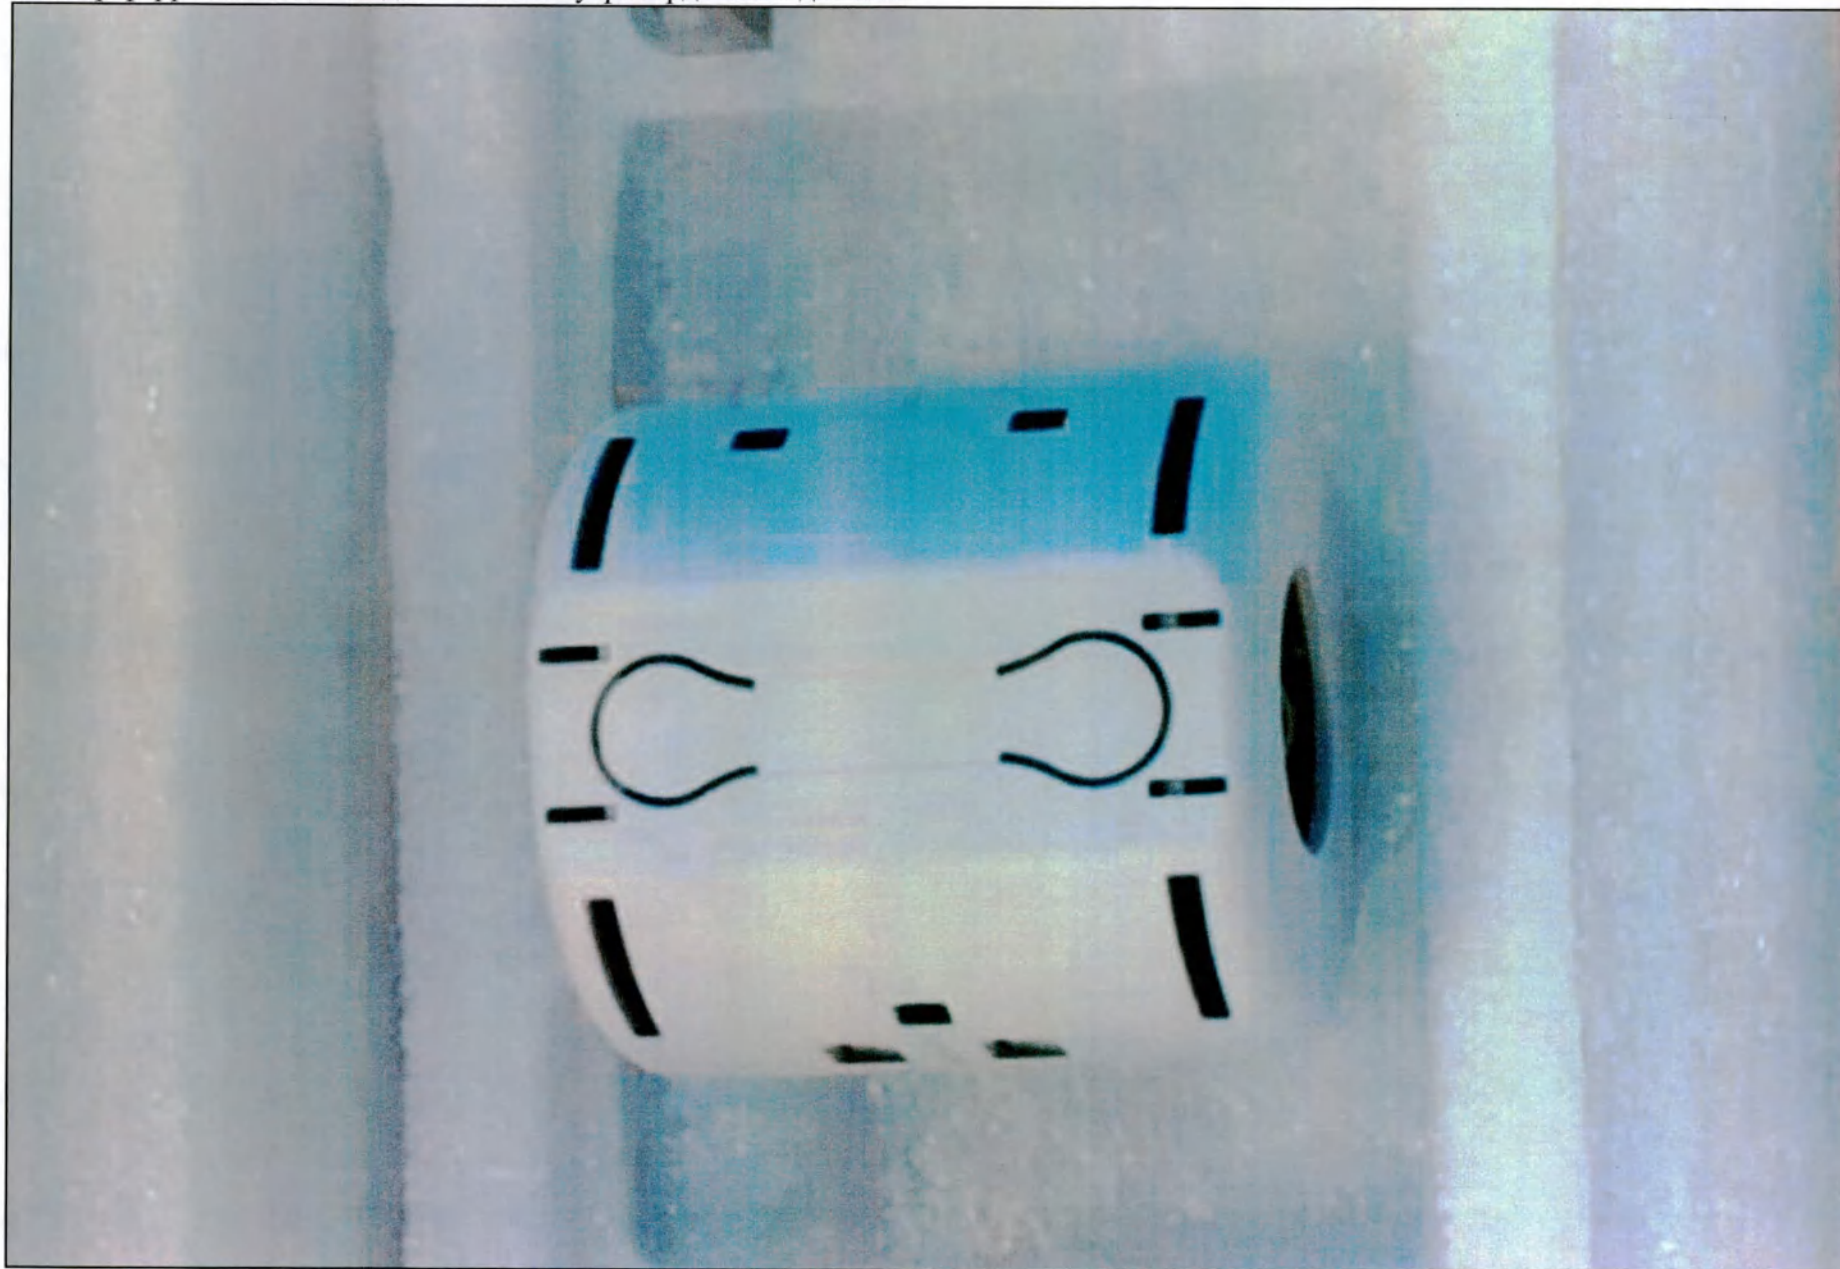


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения внутрисердечных исследований на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

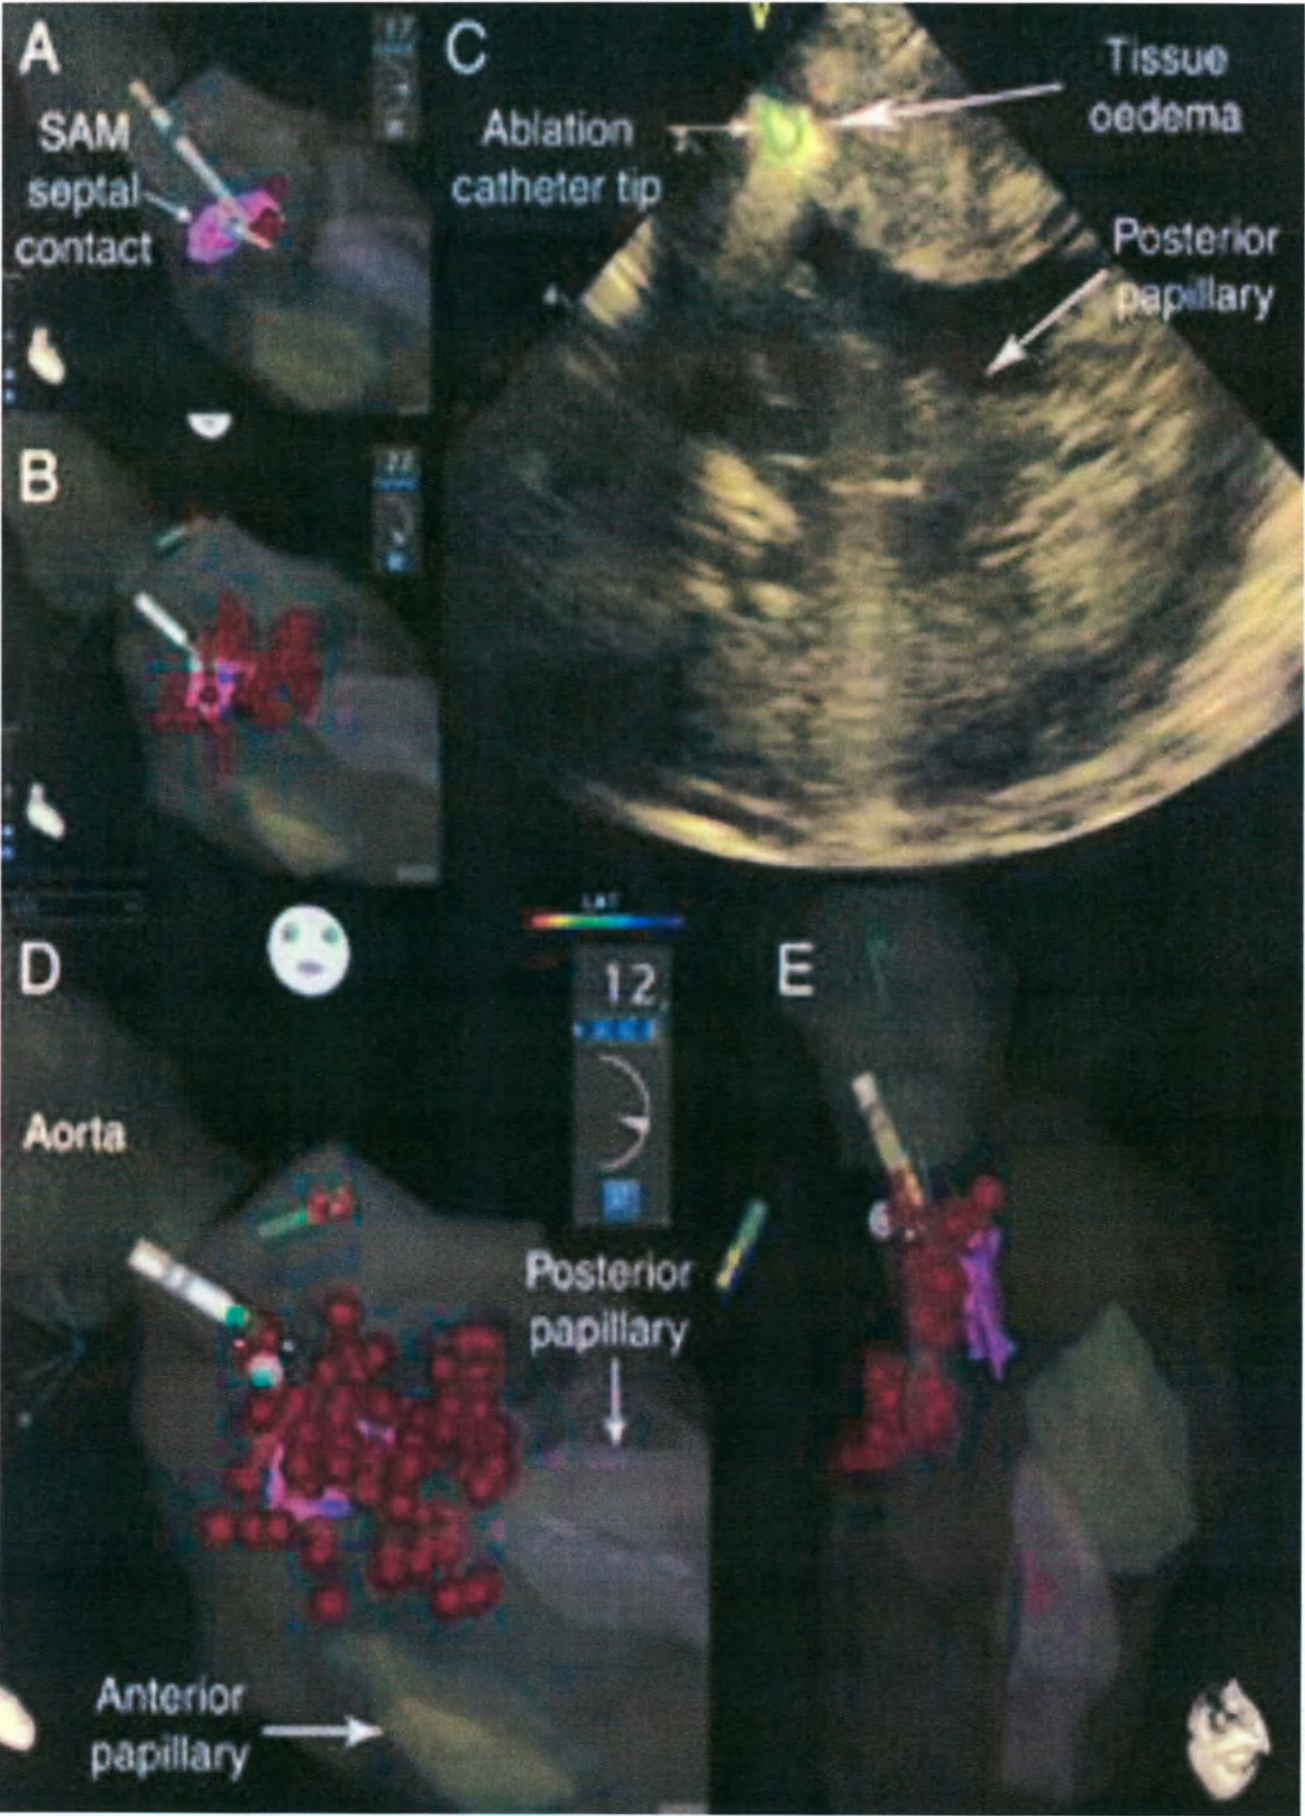


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения чреспищеводных исследований на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

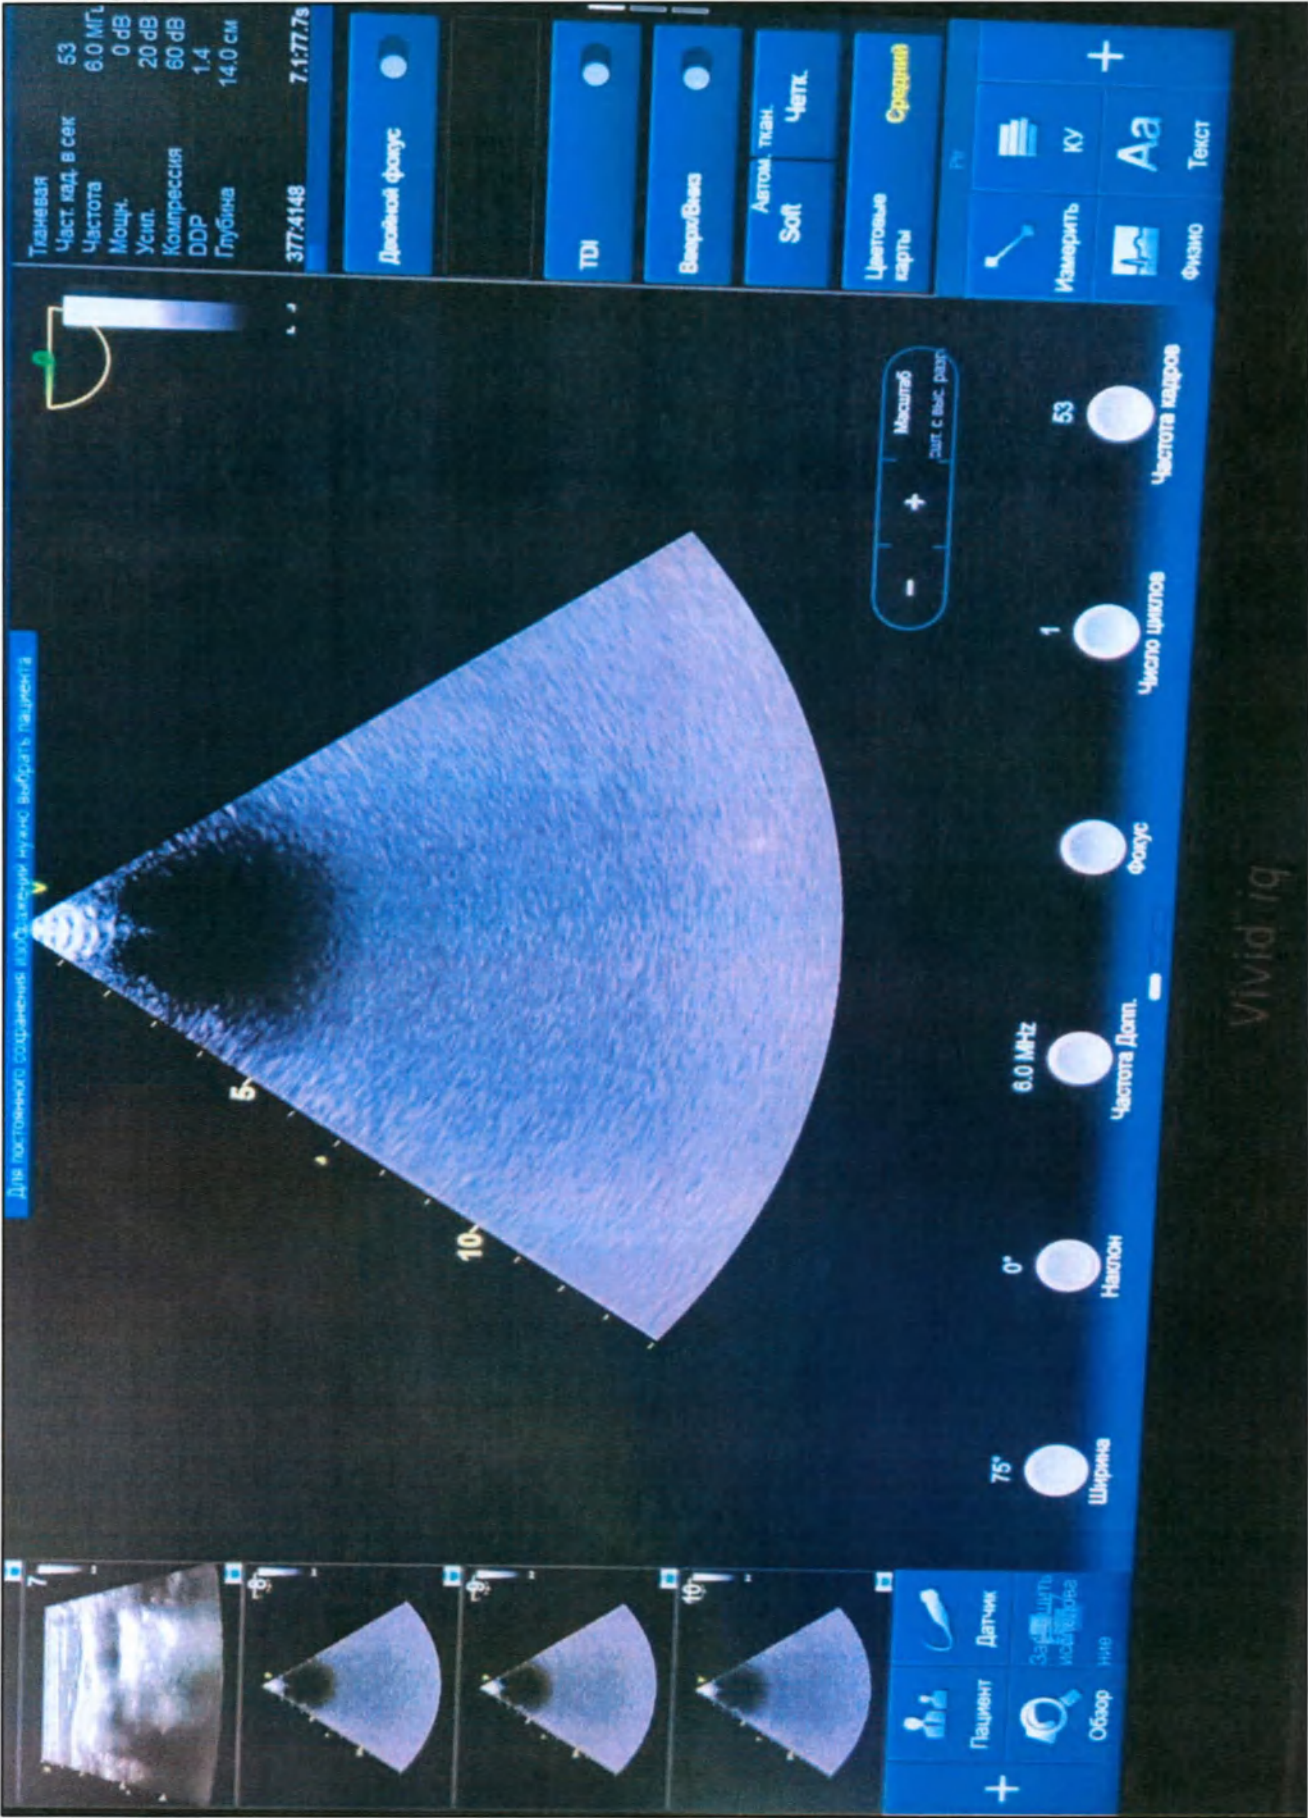


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения сосудистых исследований на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

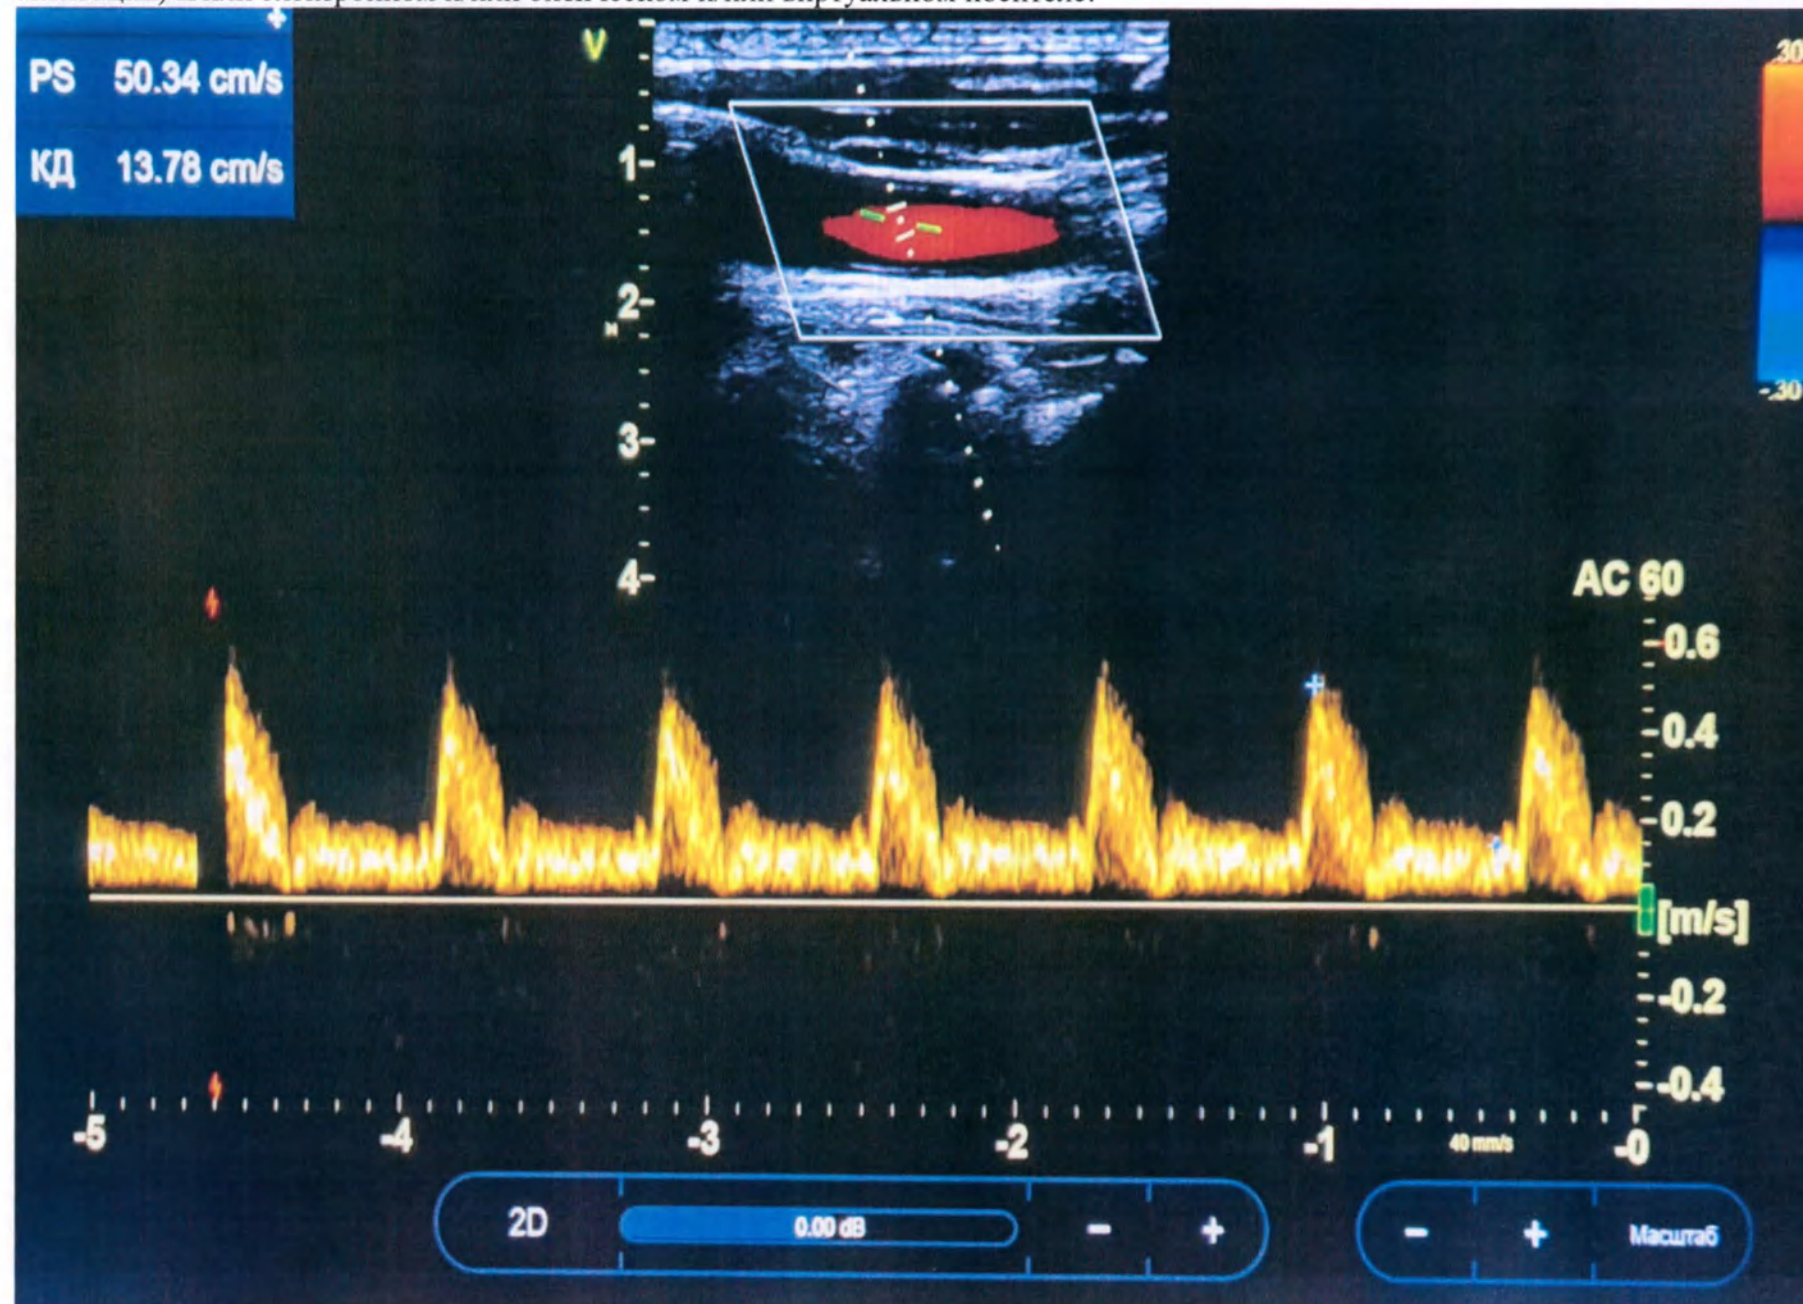


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения Стресс ЭхоКГ на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

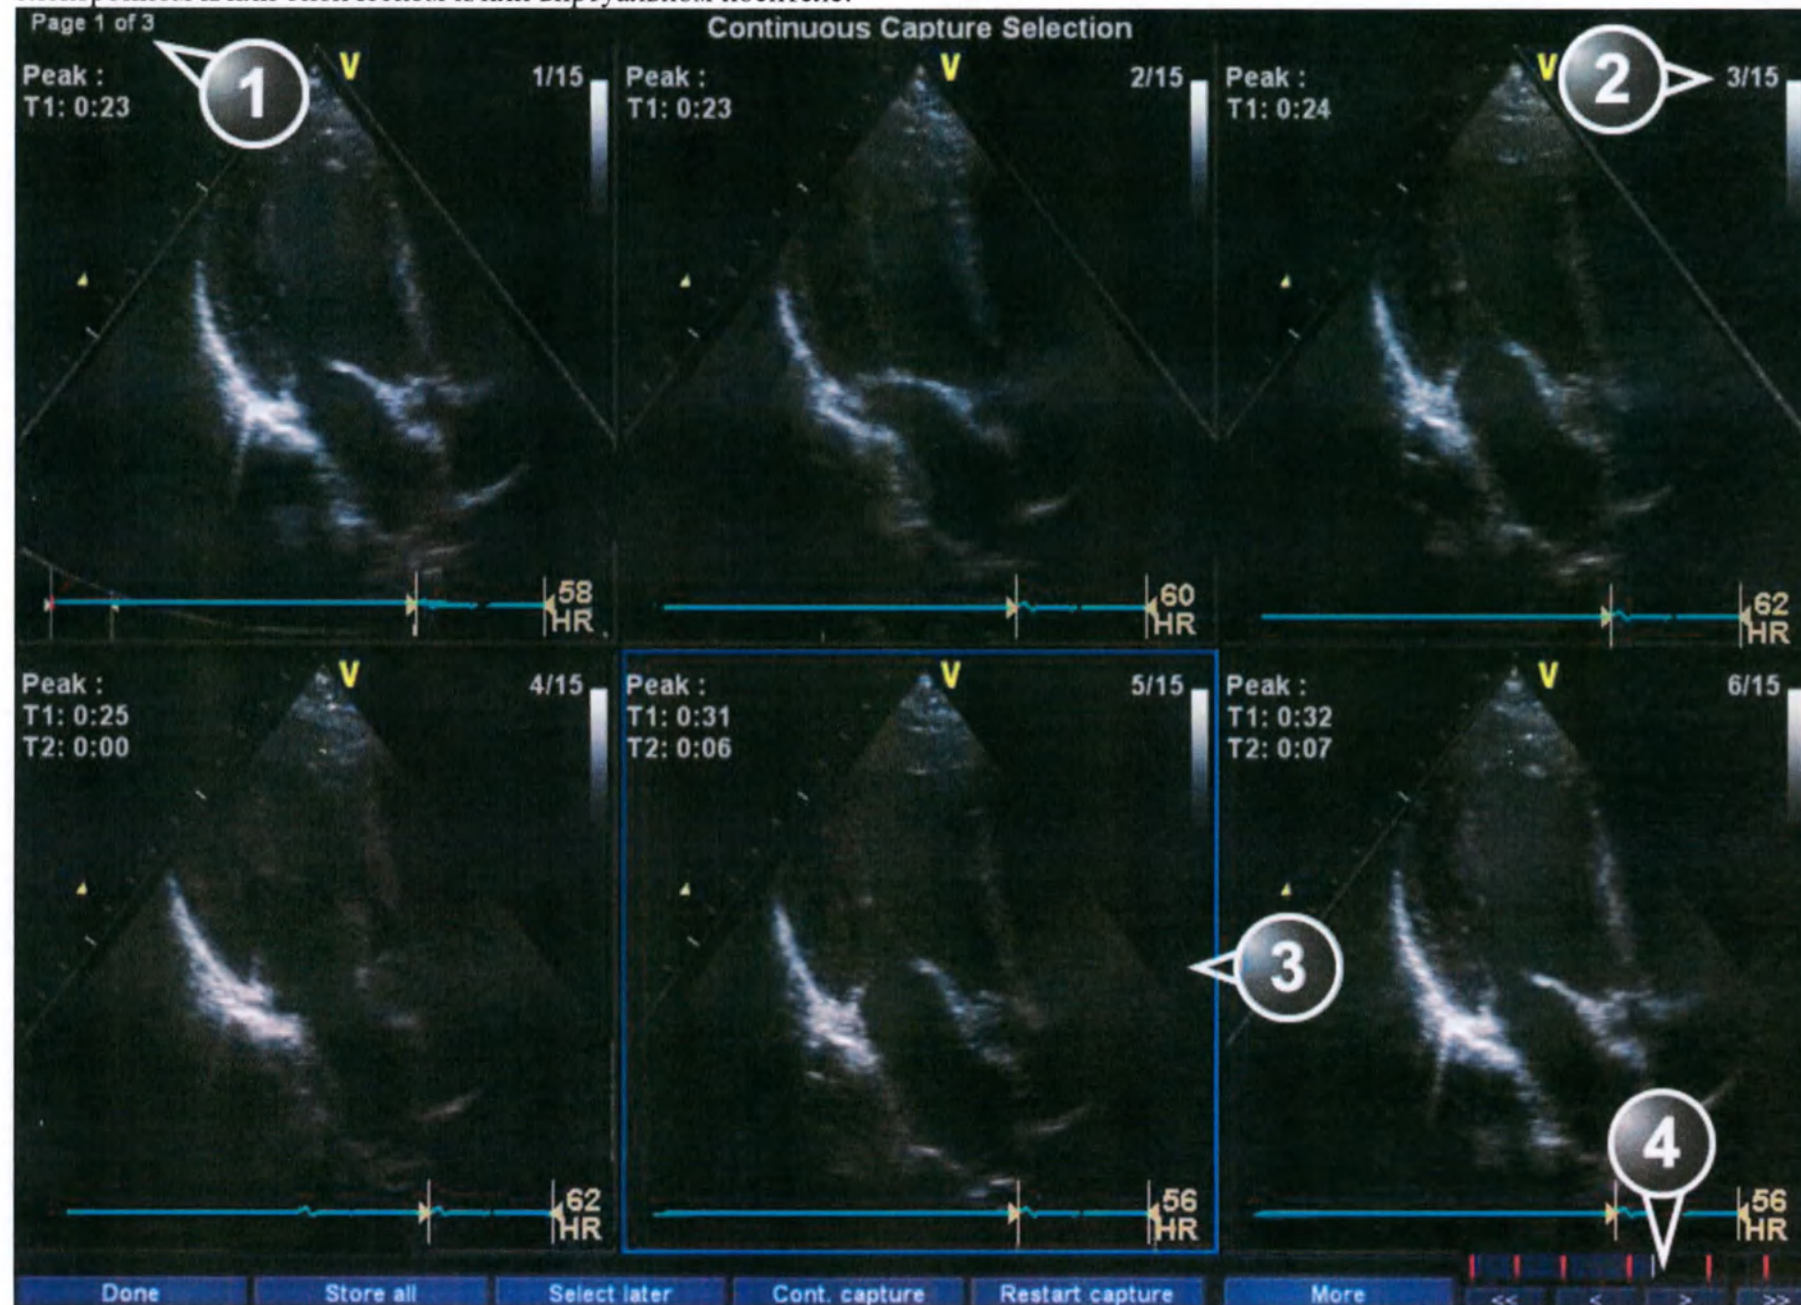


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения тканевого доплера на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

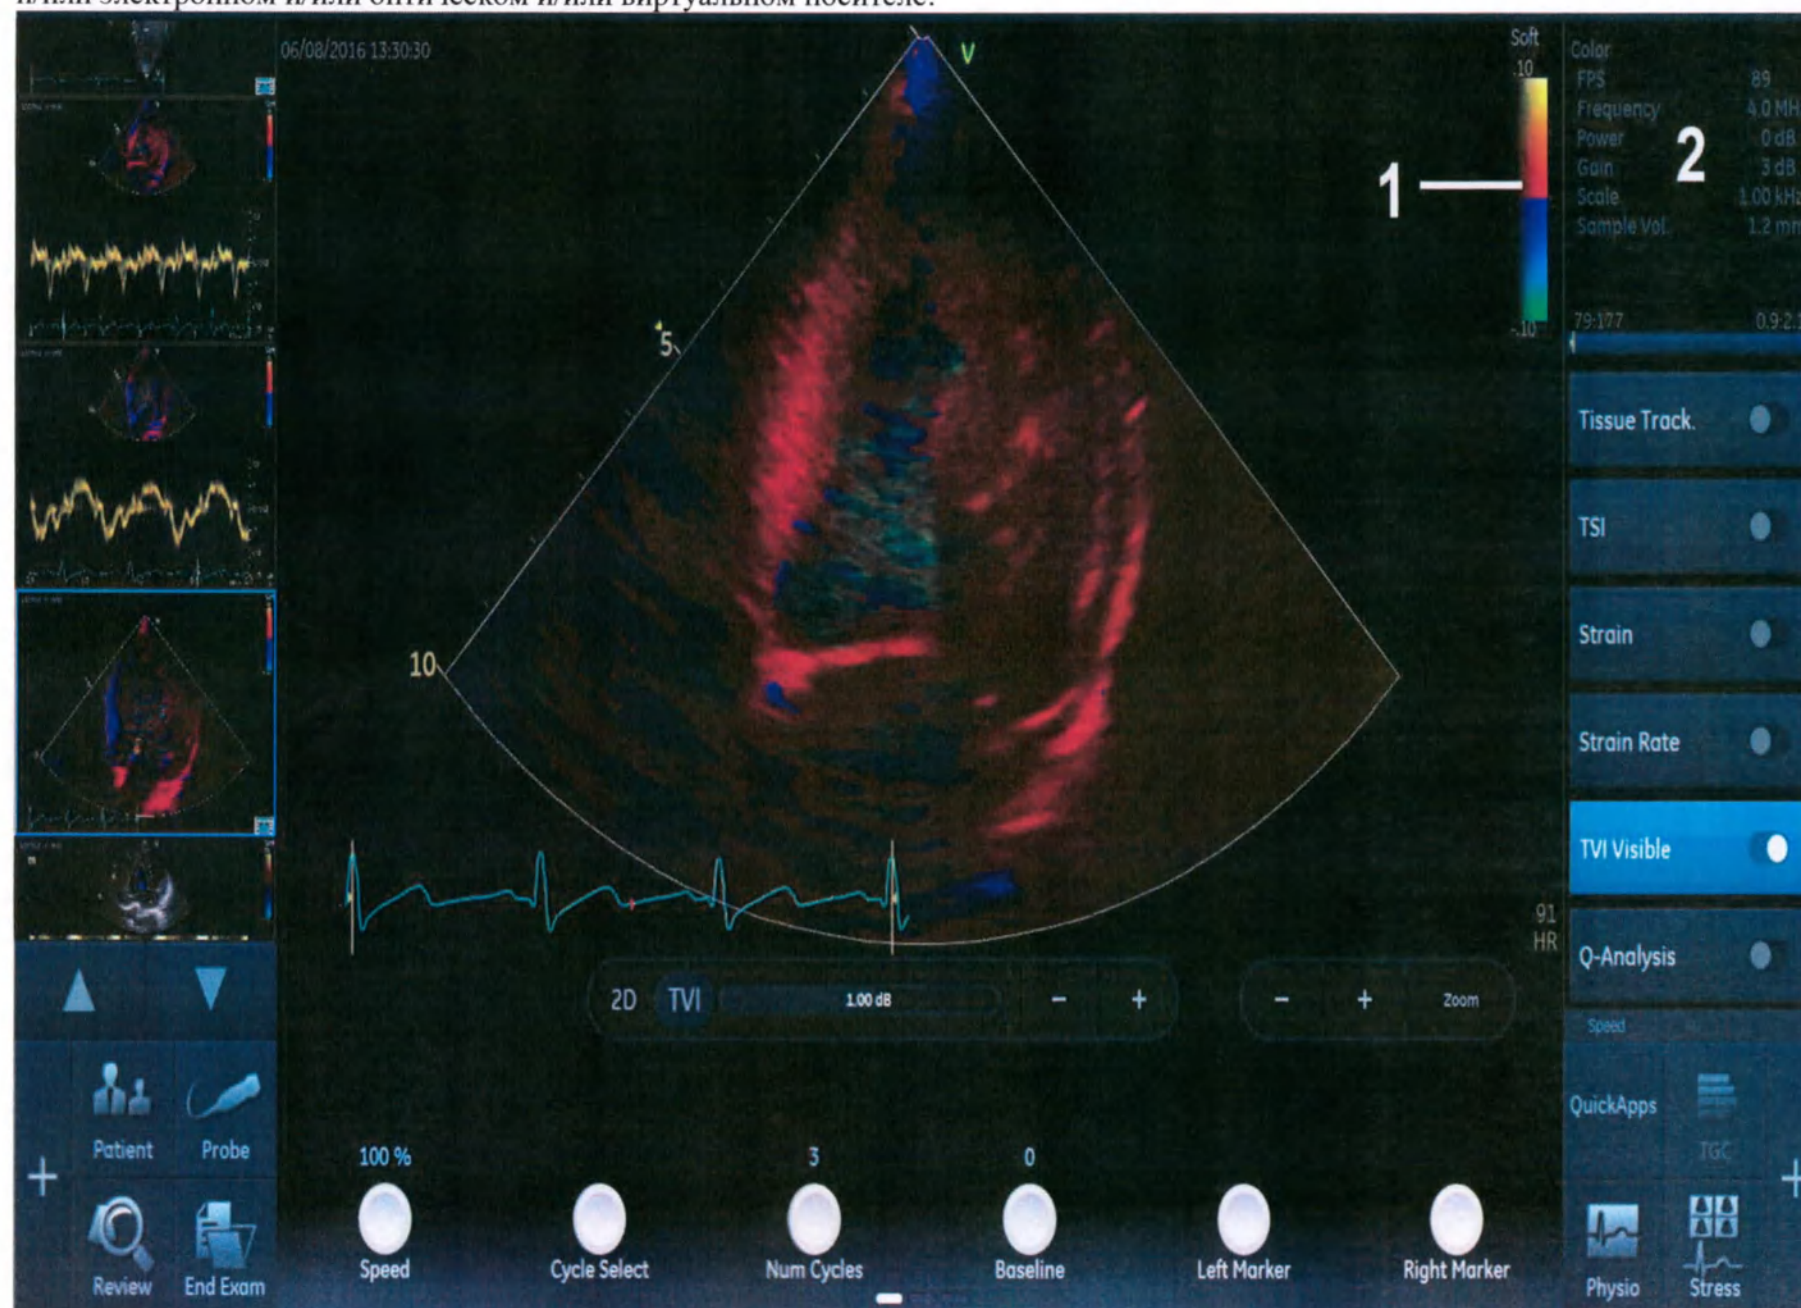


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, оценки синхронности сокращения сердца и деформации миокарда на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

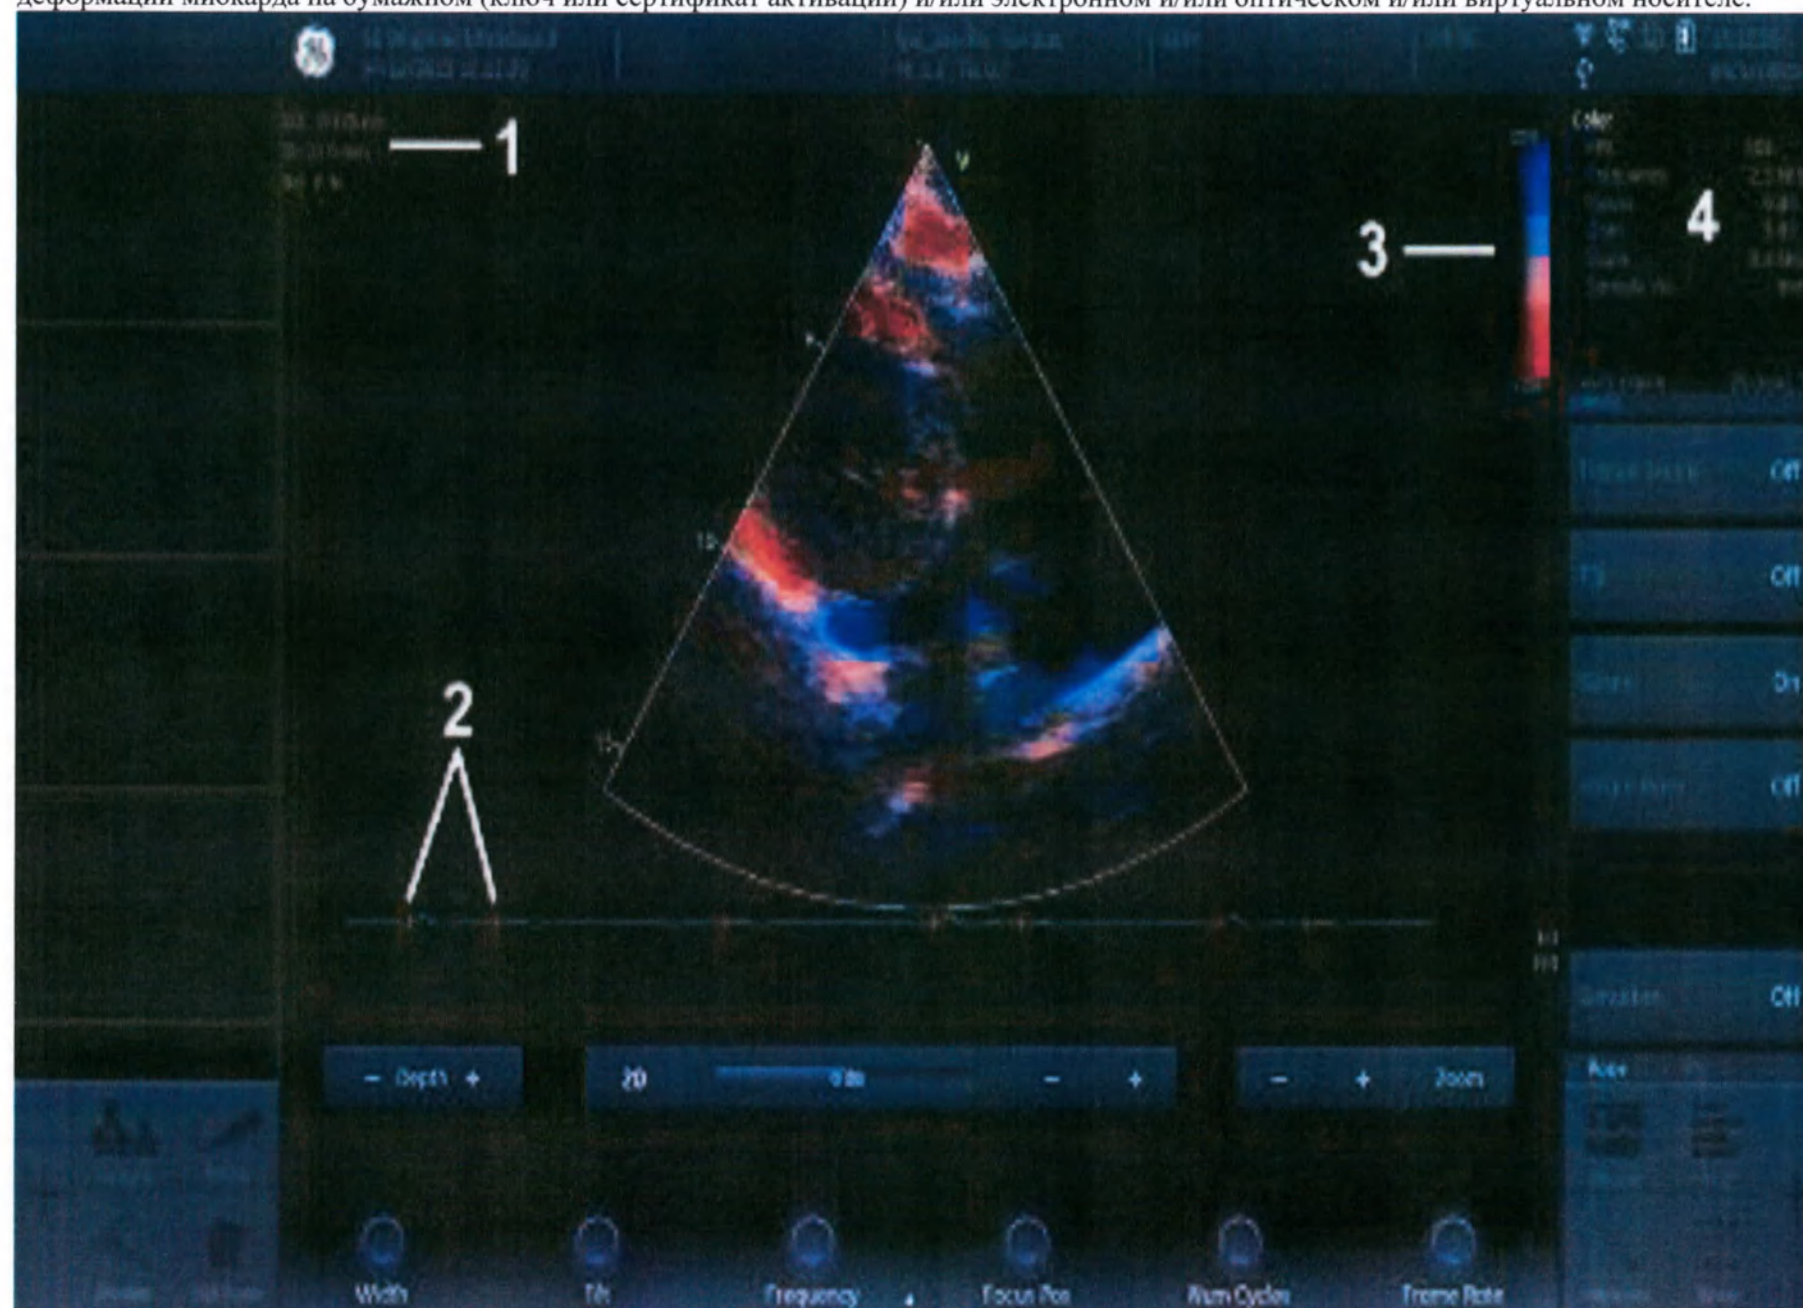


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, анализа сохраненных данных, данных тканевого доплера на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

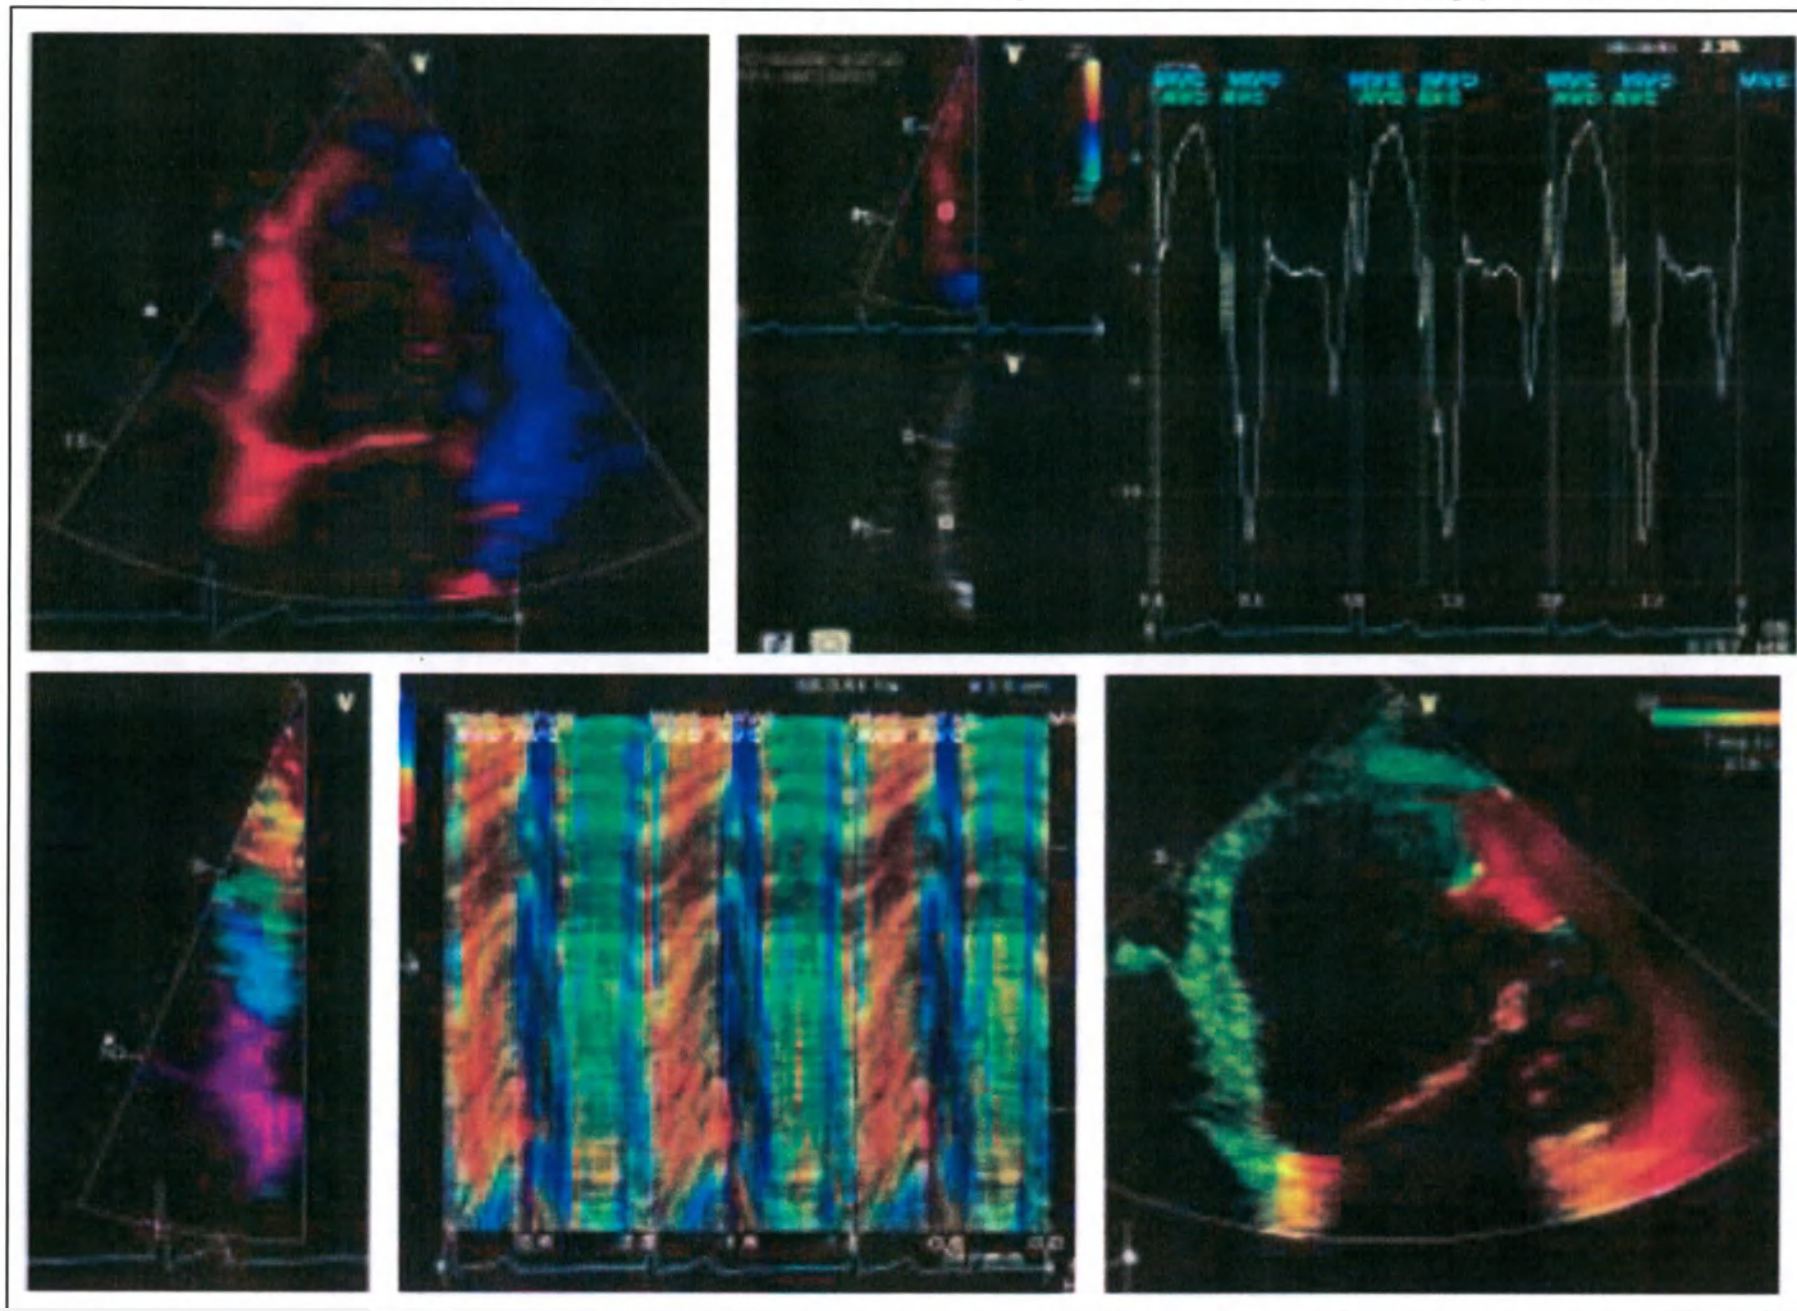


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения контрастных исследований сердца на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

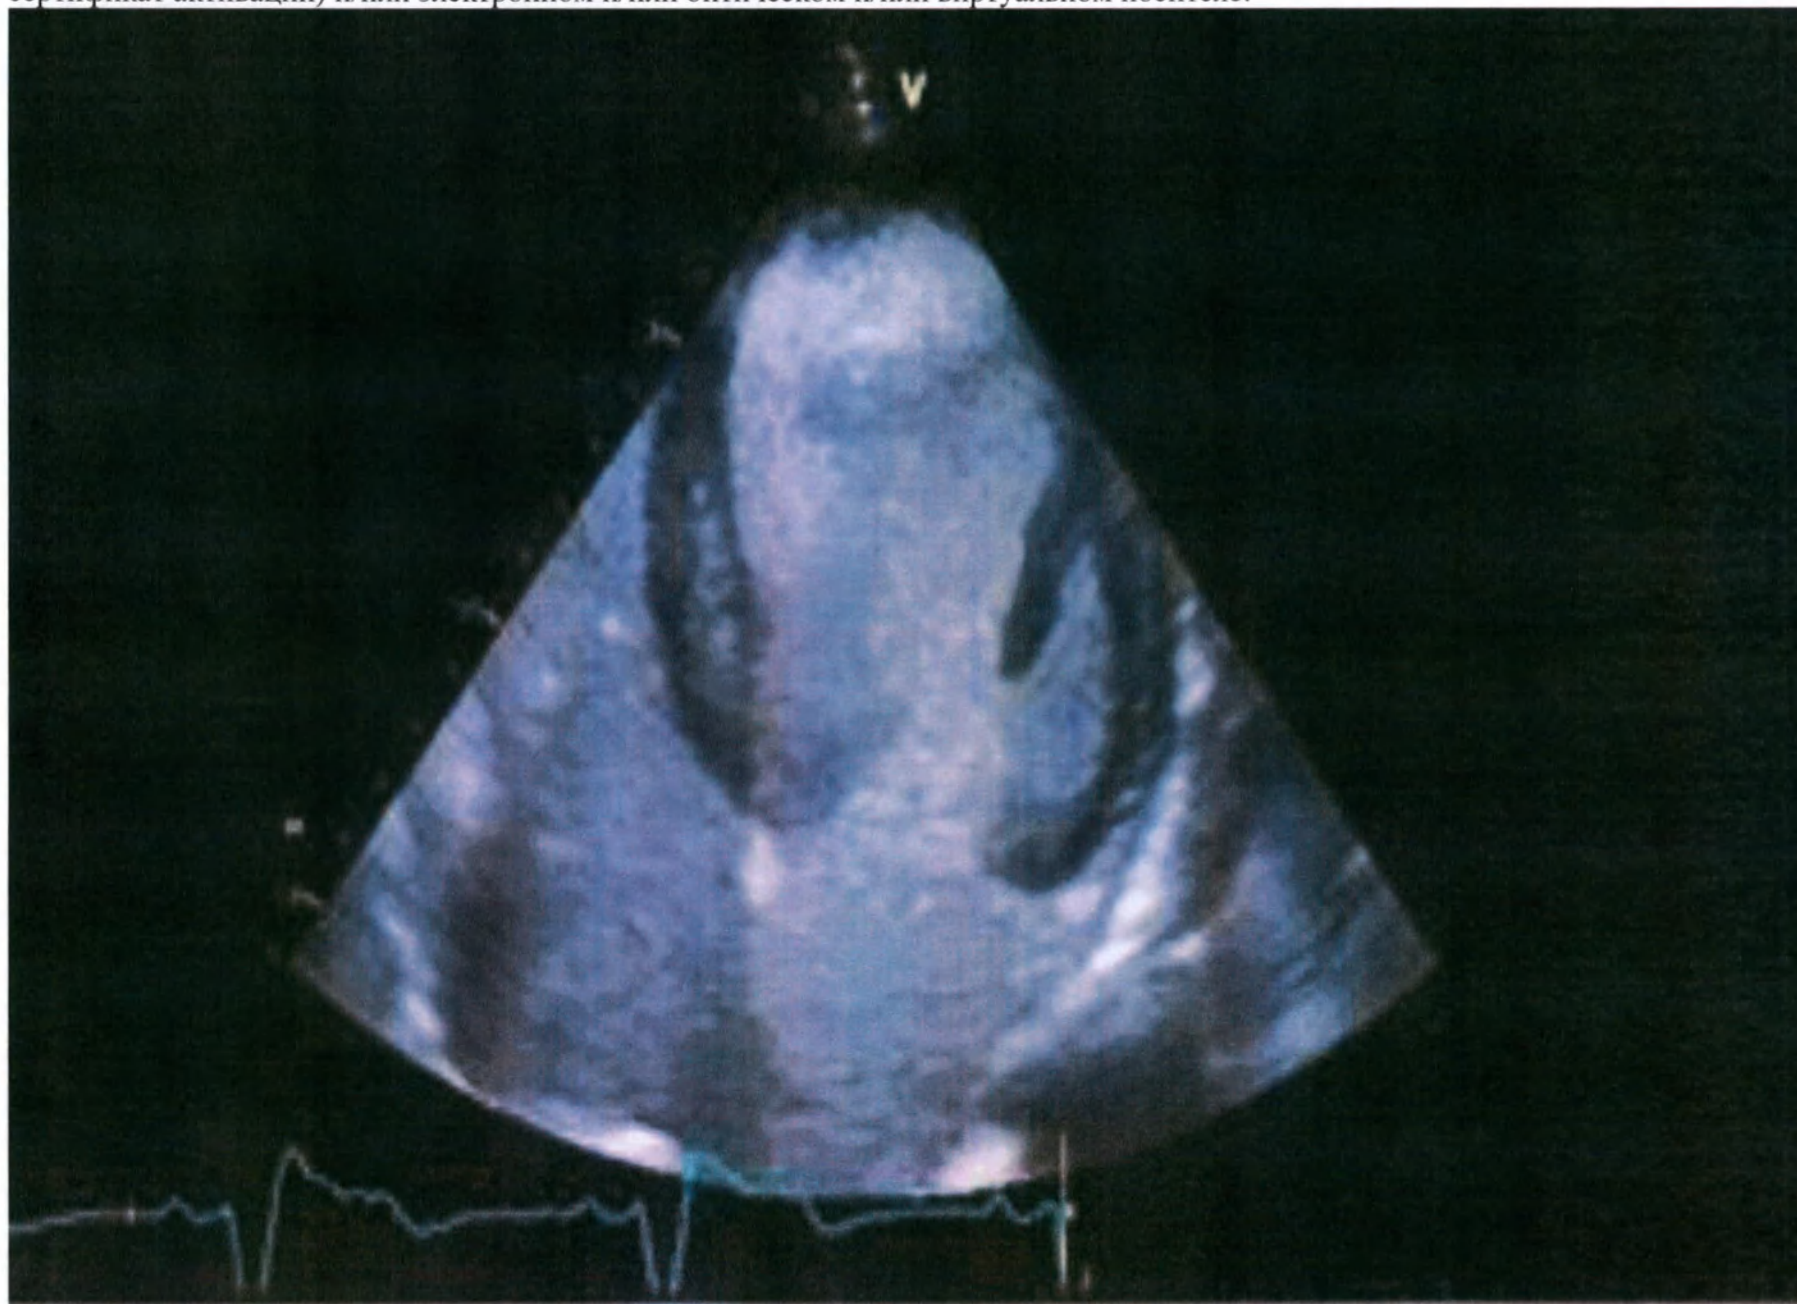

Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, неоплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции сердца, степени деформации миокарда на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

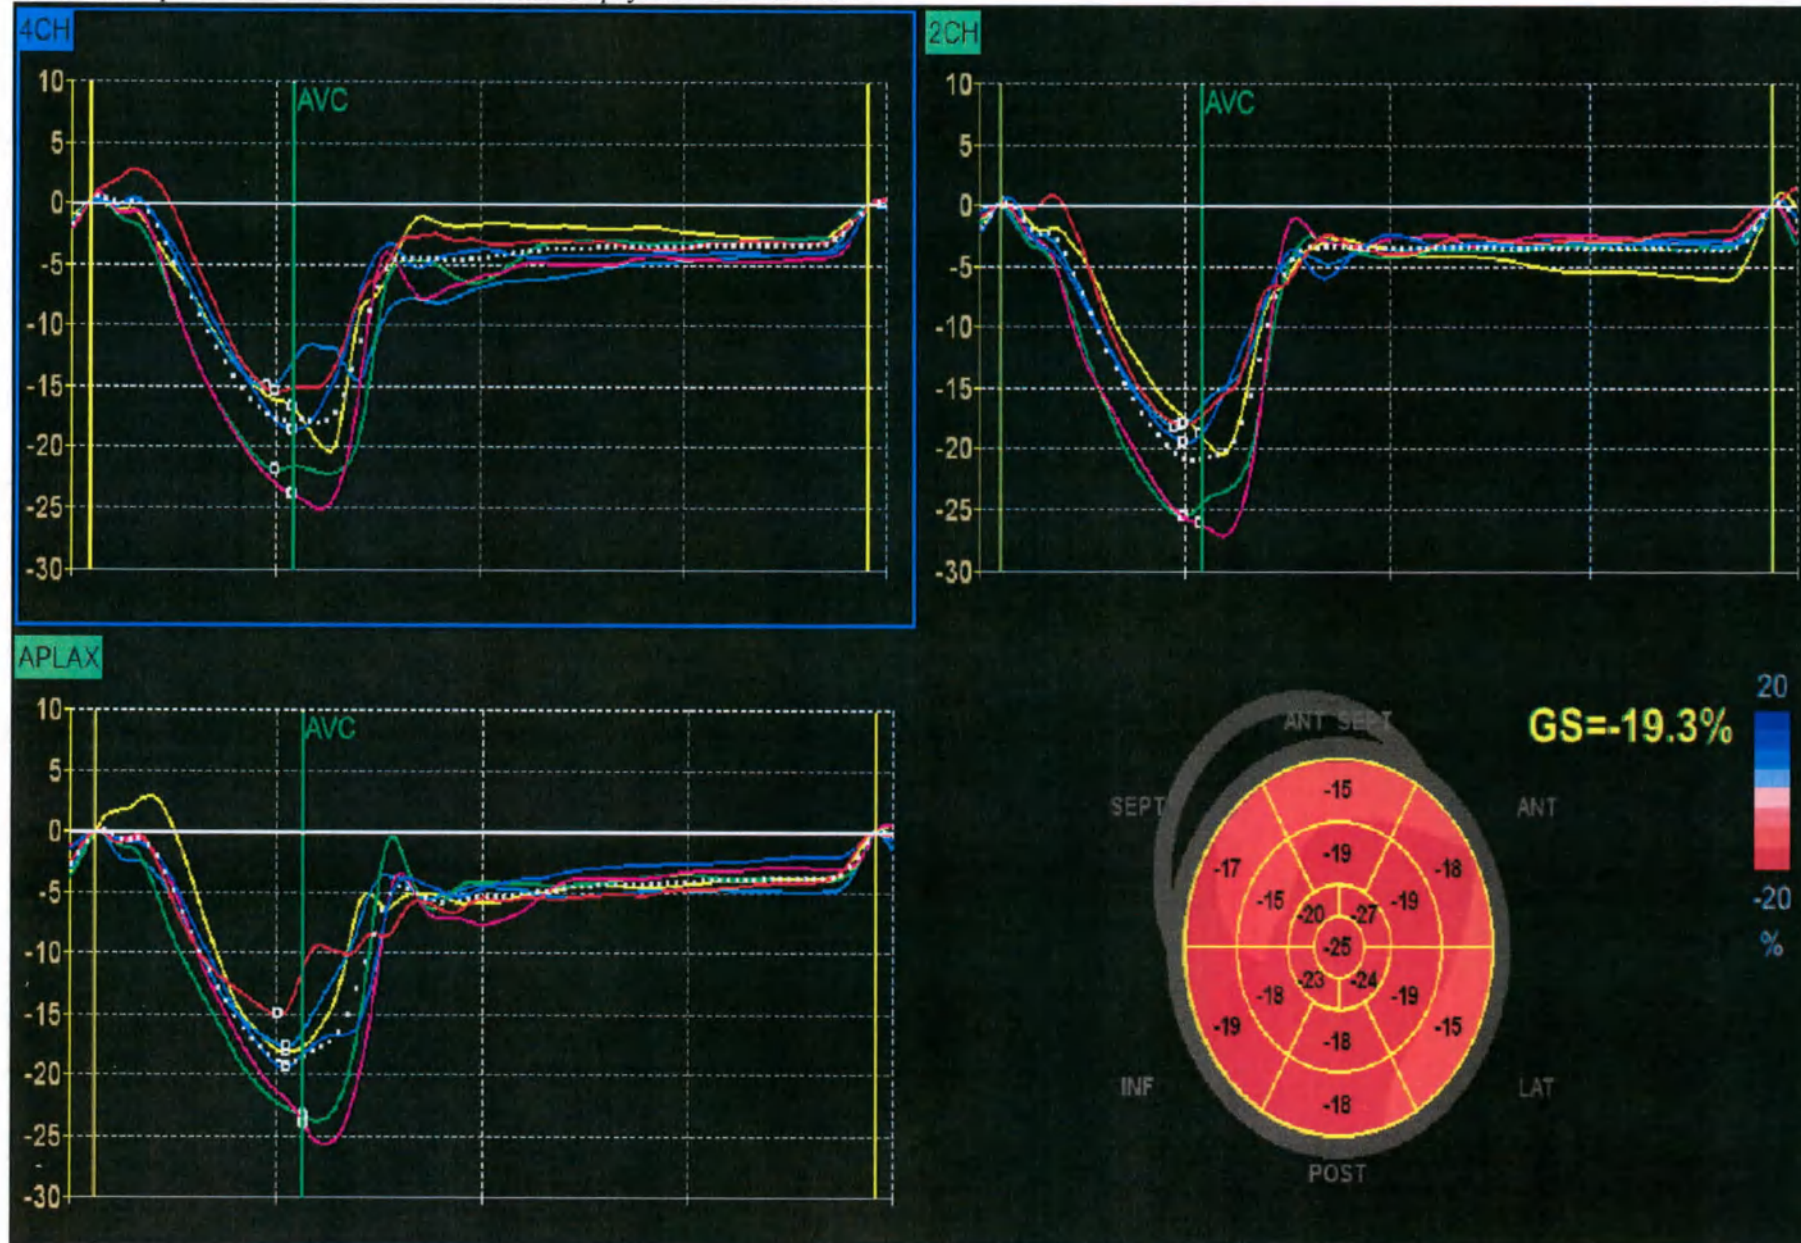


Электронный ключ для активации программного модуля для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, цифровой неоплеровской количественной оценки глобальной и региональной функции правого желудочка на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

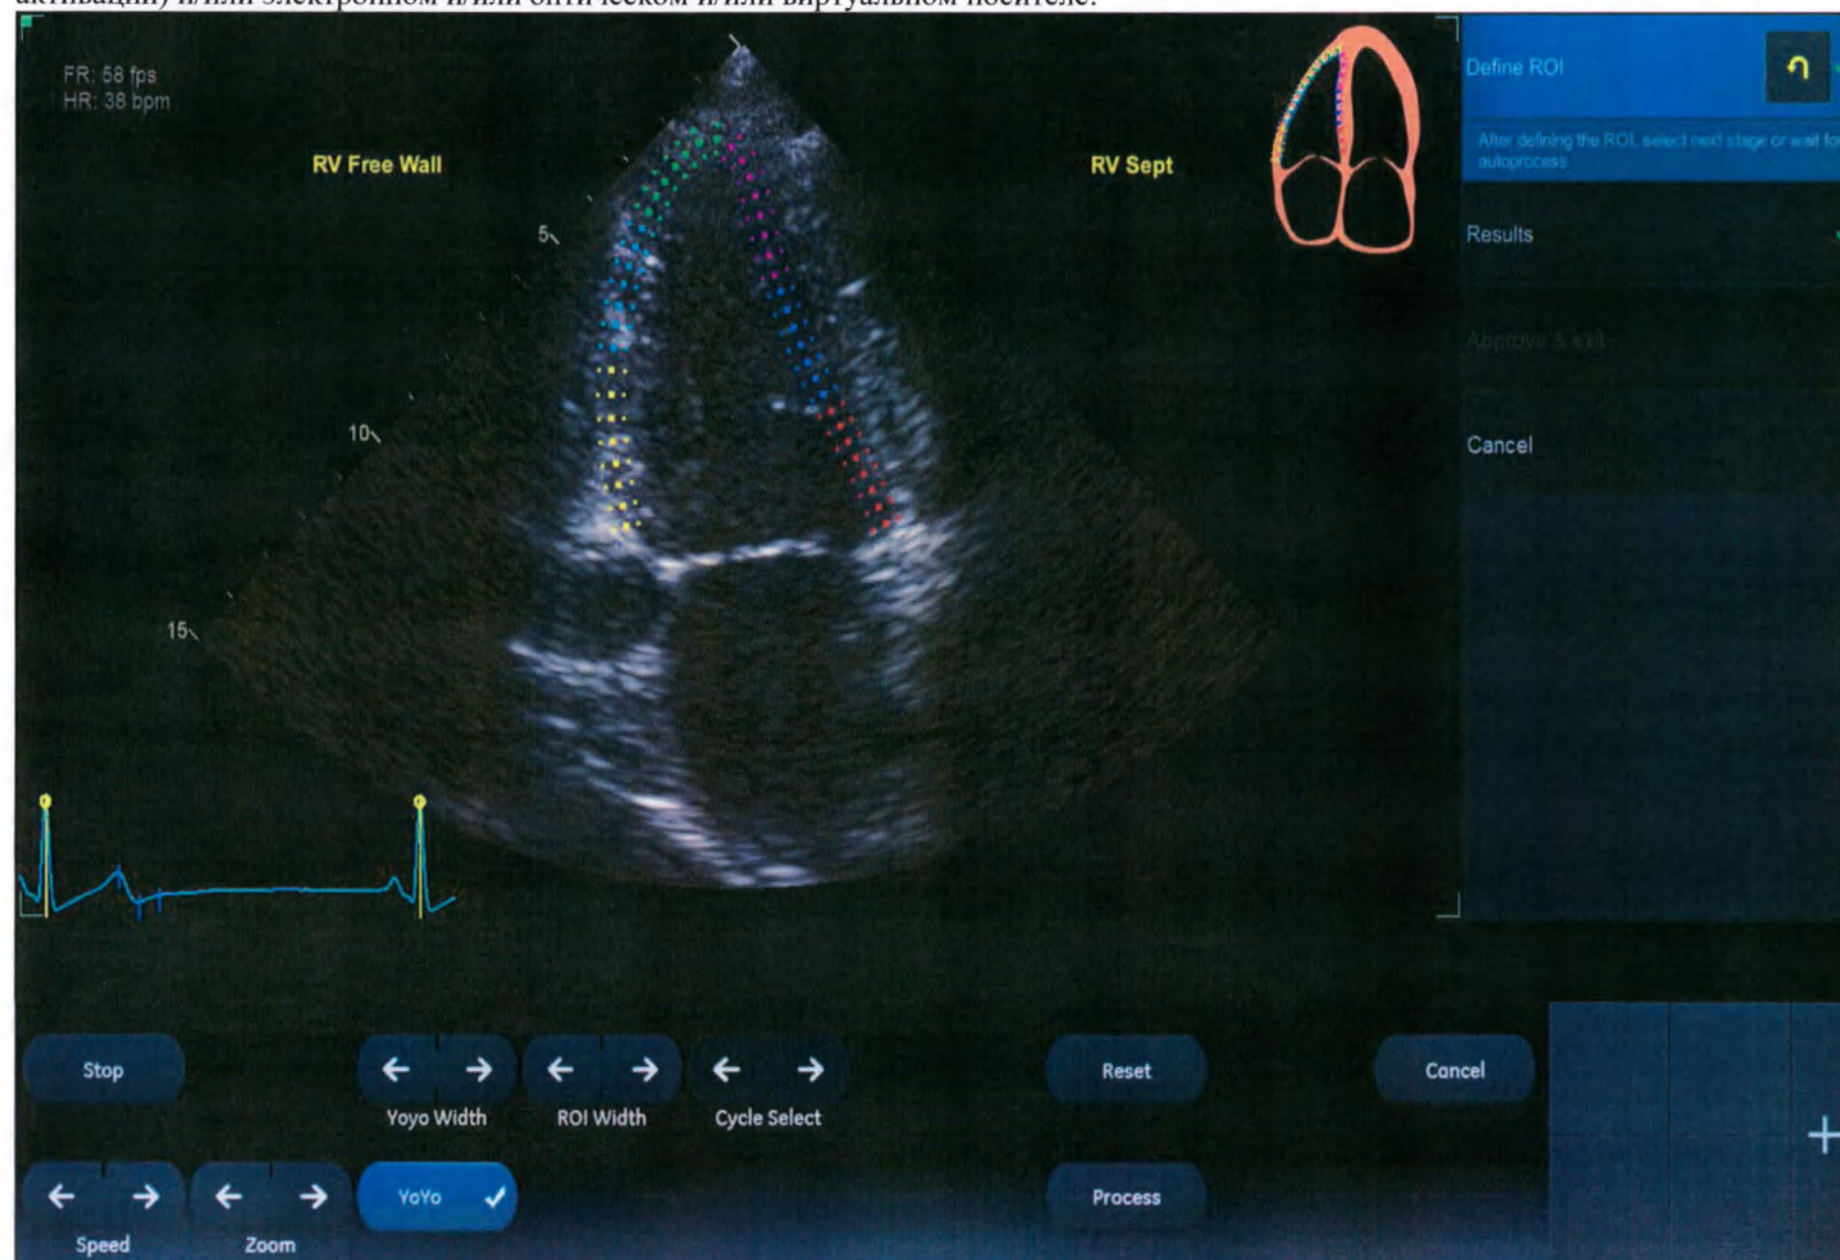

Электронный ключ для активации программного модуля для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, цифровой недоплеровской полуавтоматической количественной оценки глобальной функции левого предсердия на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.




Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, автоматической оценки глобальной сократительной функции сердца на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

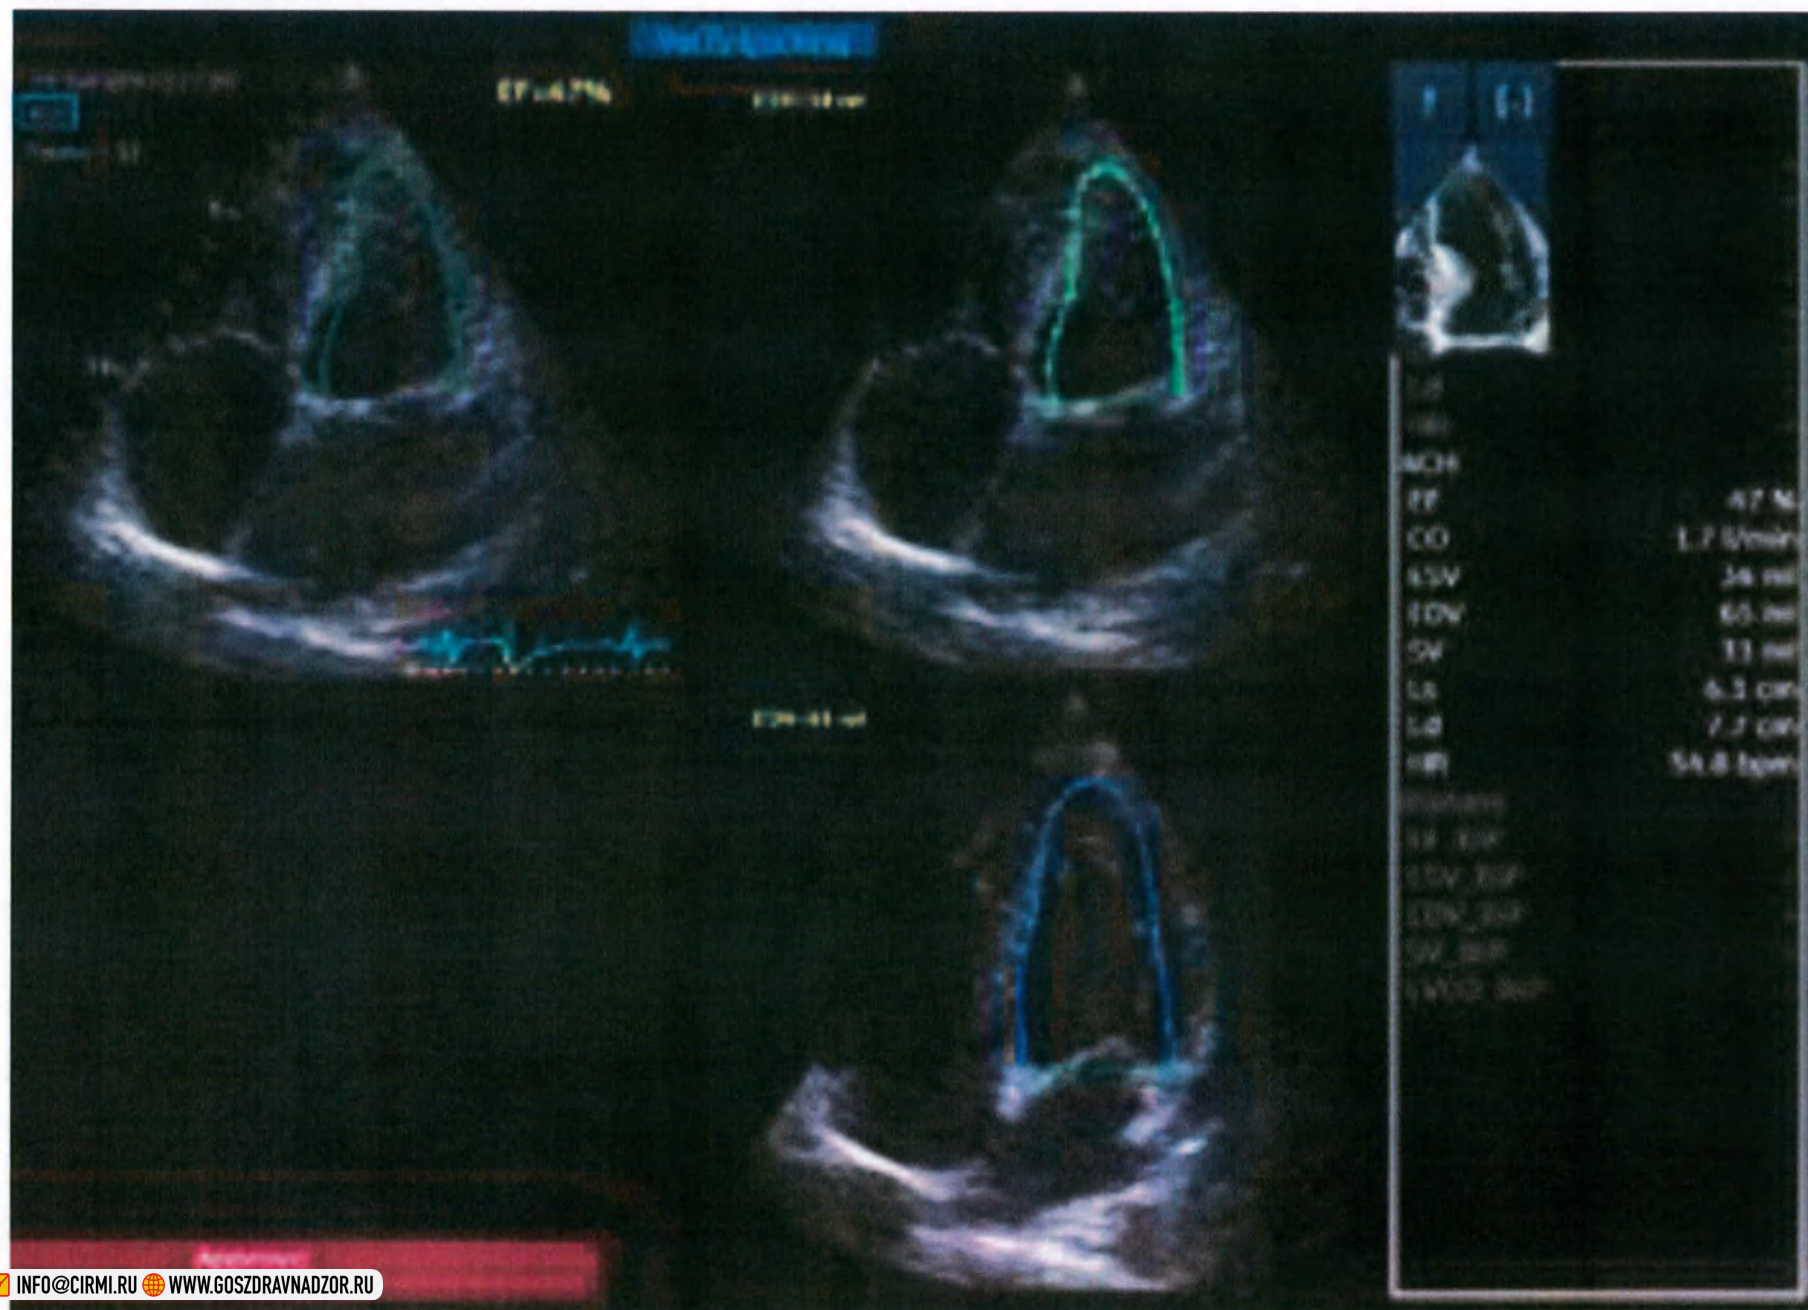

Электронный ключ для активации программного модуля для проведения высокоточных сосудистых исследований, неопплеровской оценки кровотока в сосудах на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.



Электронный ключ для активации программного модуля для конусовидного расширения дистального поля при работе с линейным датчиком на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.


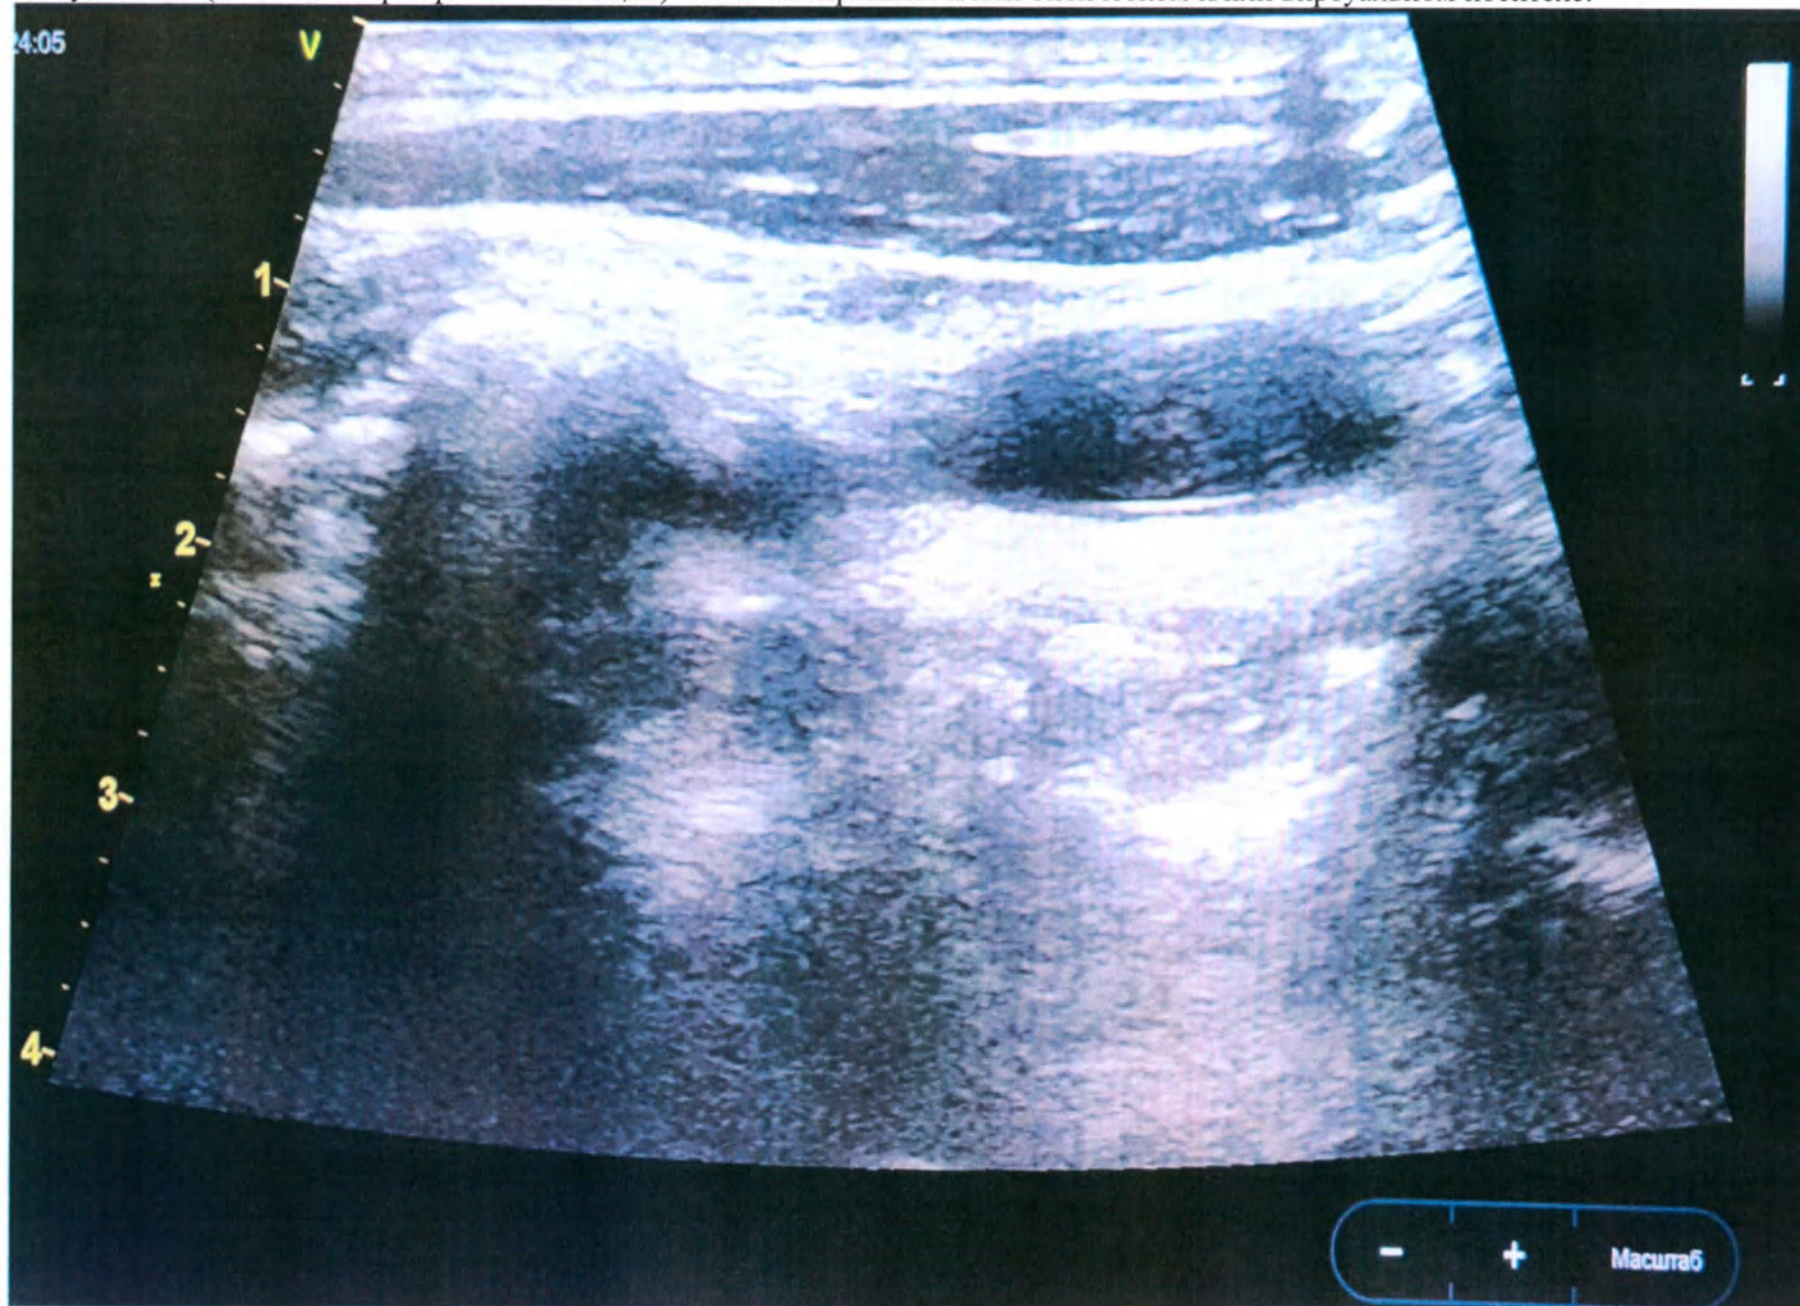


Электронный ключ для активации программного модуля для панорамного сканирования на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.



[illegible]


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, оценки толщины стенки сосуда на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

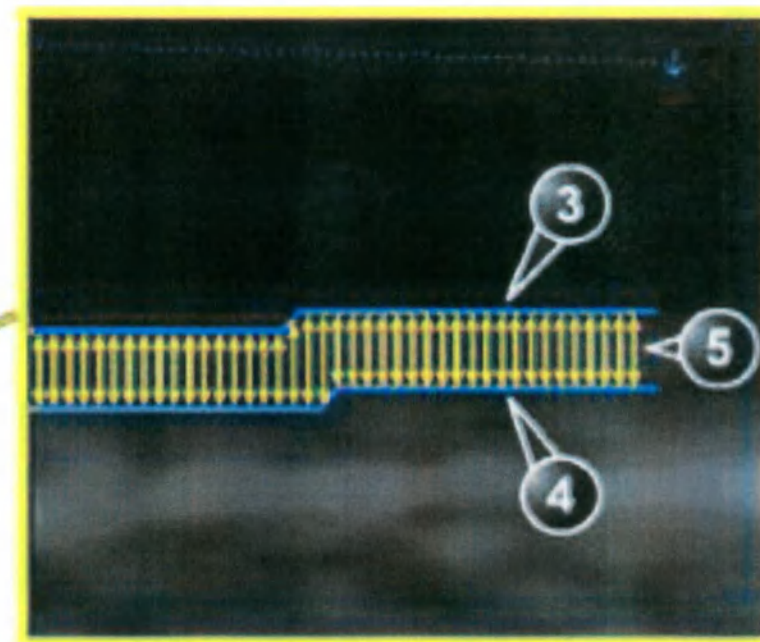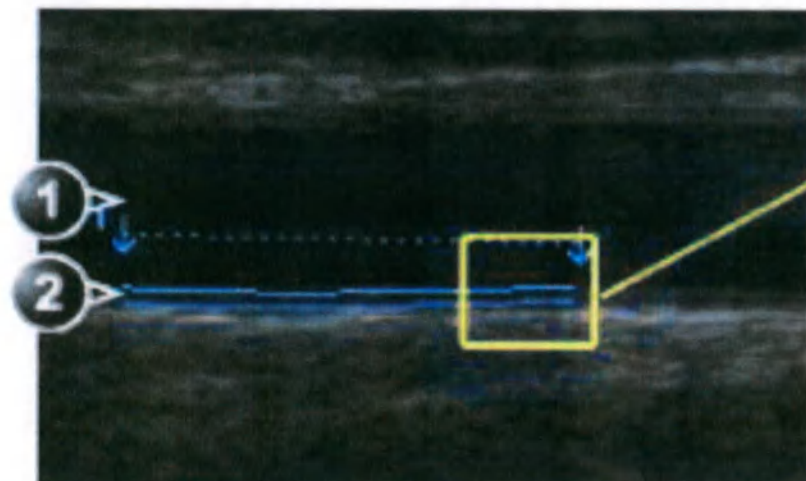


1. Vessel lumen (Просвет сосуда)
2. Vessel wall (Сосудистая стенка)

3. Lumen-Intima boundary (Граница просвет-интима)
4. Media-Adventitia boundary (Граница адвентициальной оболочки)
5. Multiple IMT measurements (Множественное измерение ТИМ)

Электронный ключ для активации программного модуля для доступа к расширенному пакету измерений и анализа в акушерстве и гинекологии на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

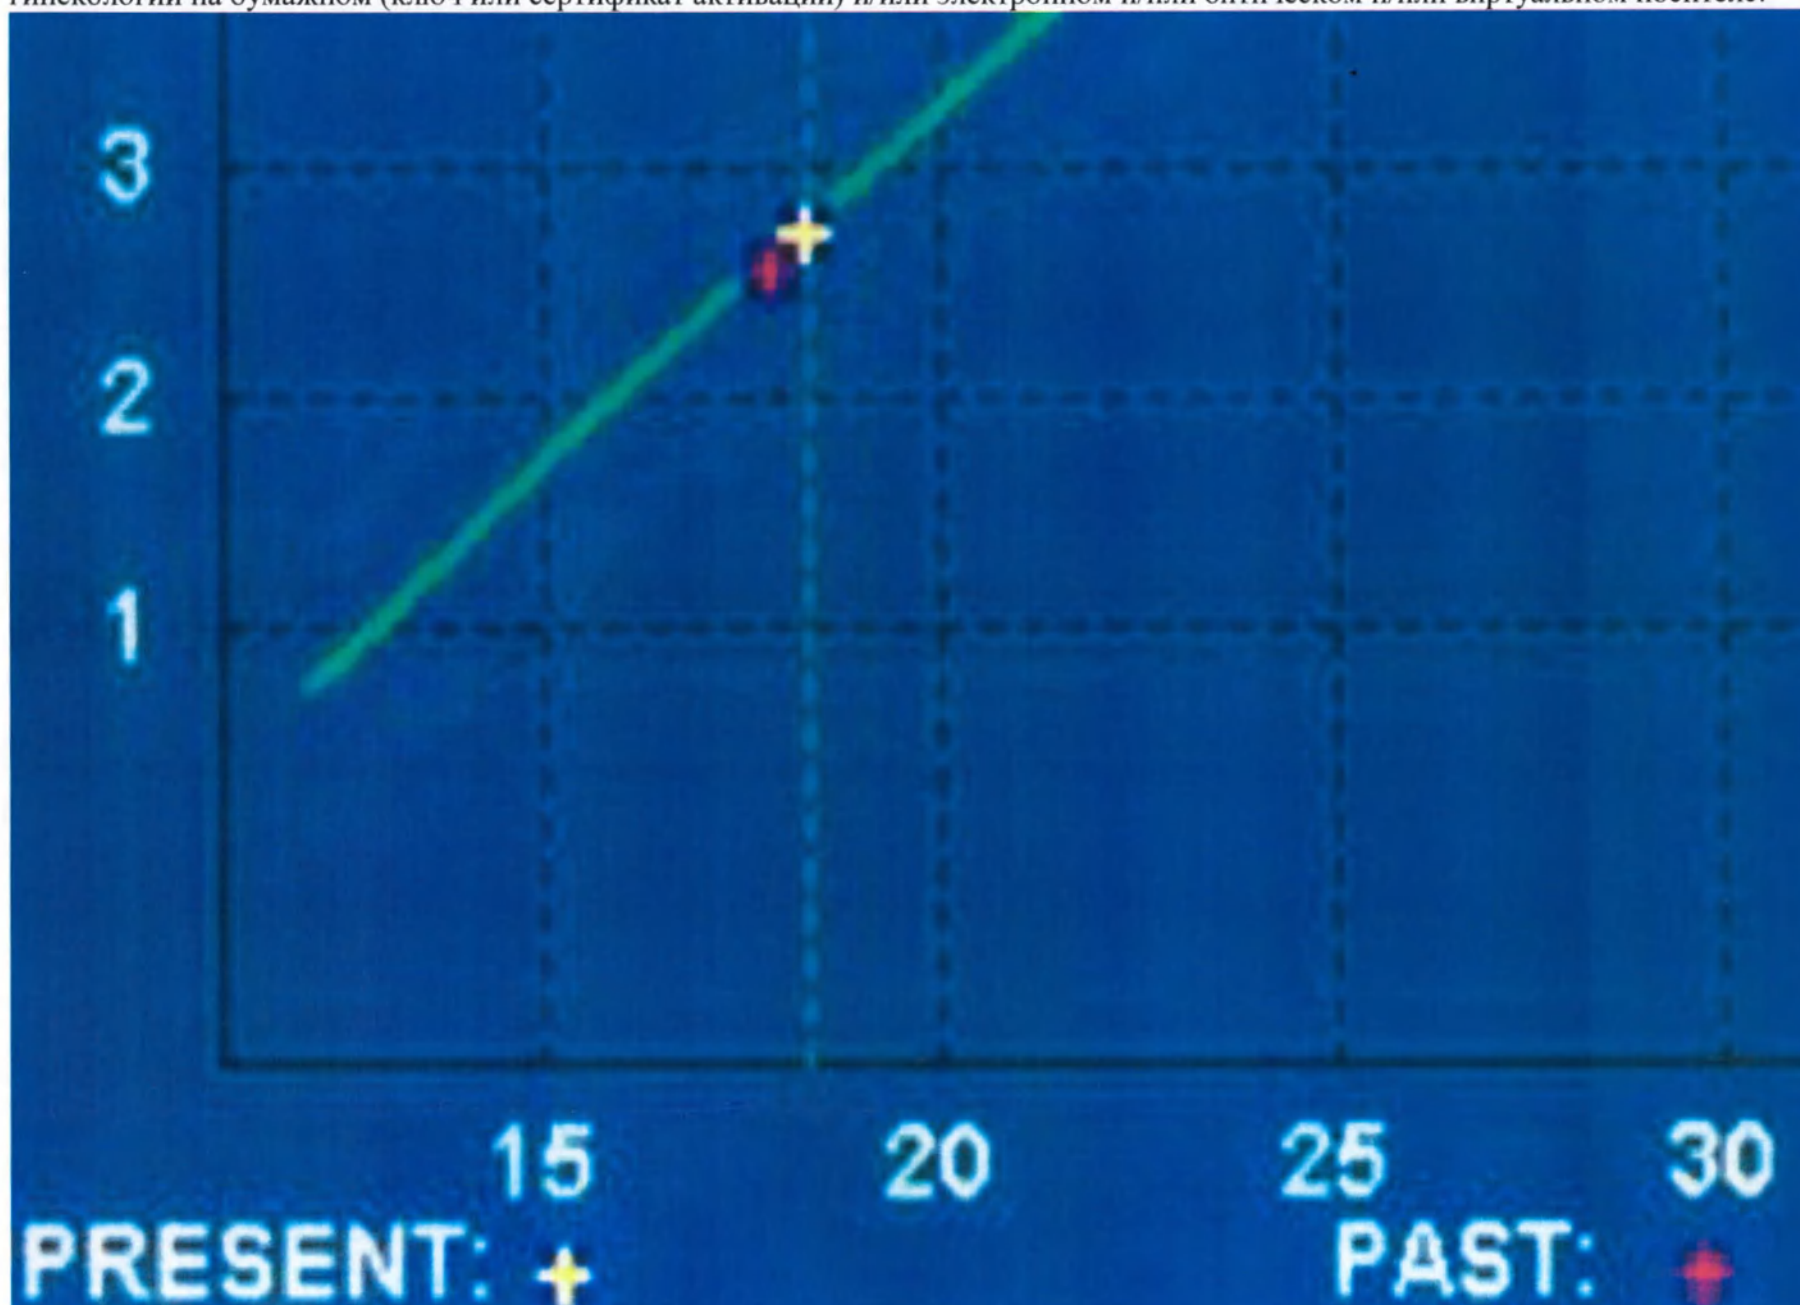

Электронный ключ для активации программного модуля для взаимодействия ультразвукового аппарата с навигационной системой CartoSound на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

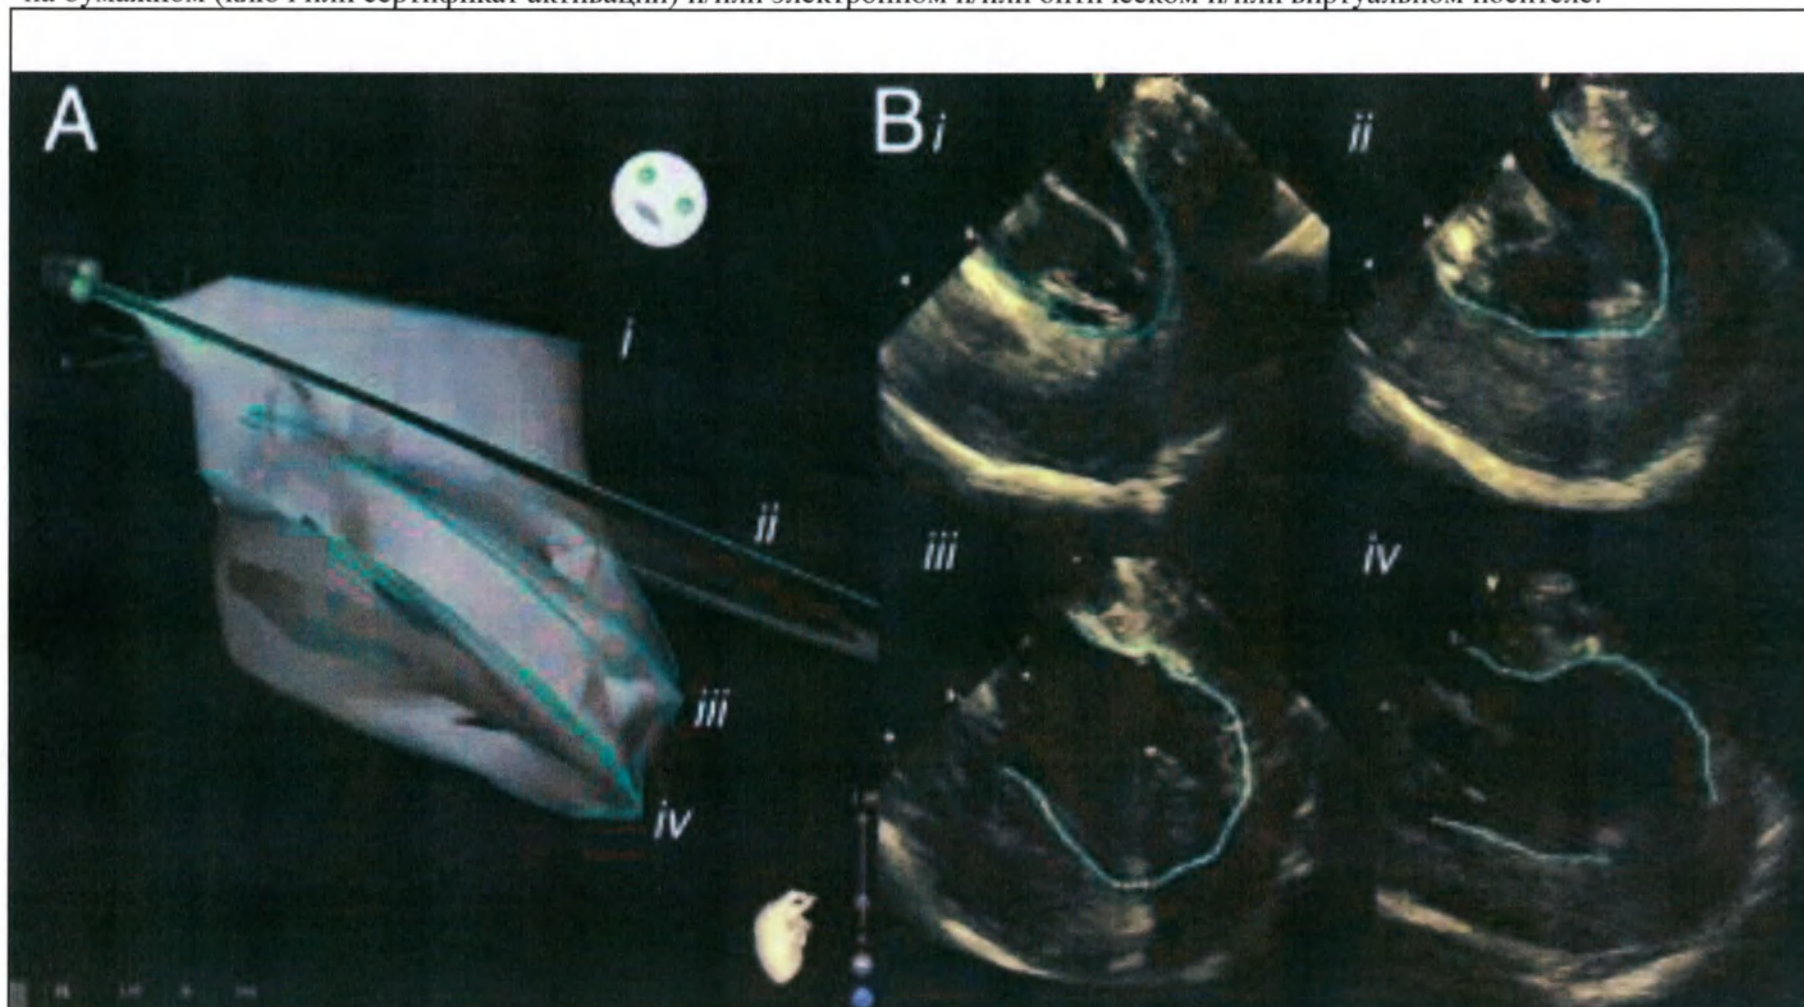


Изолированный преобразователь объединитель видео сигнала HDMI (видеосплиттер).




Электронный ключ для активации программного модуля для взаимодействия ультразвукового аппарата с системой CardioLab и Mac-Lab на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.




Электронный ключ для активации программного модуля, позволяющий передавать и отображать видеоизображение с рентгеновских или ангиографических систем на экране ультразвуковой системы, на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе, в комплекте с преобразователем видеосигнала.

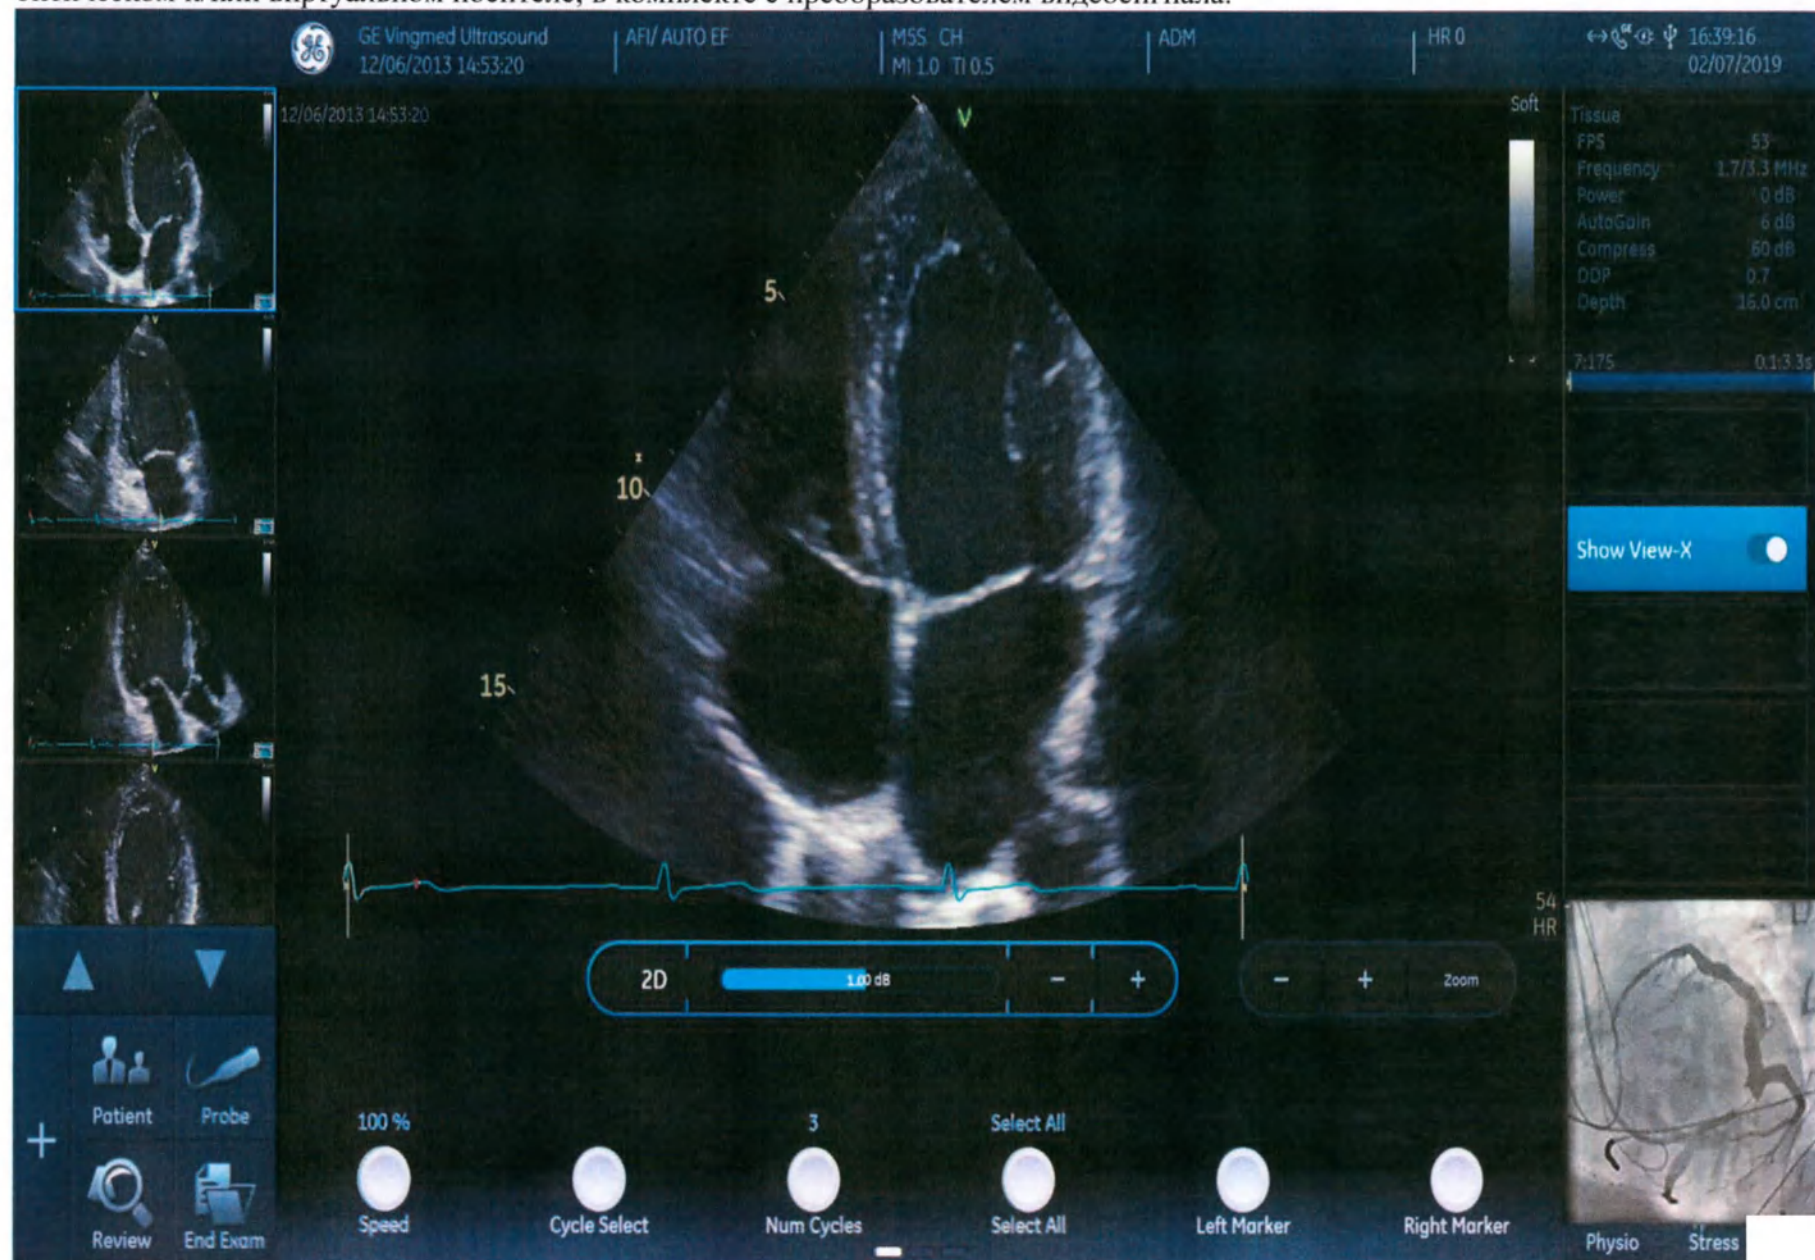


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, получения 2D и 3D ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

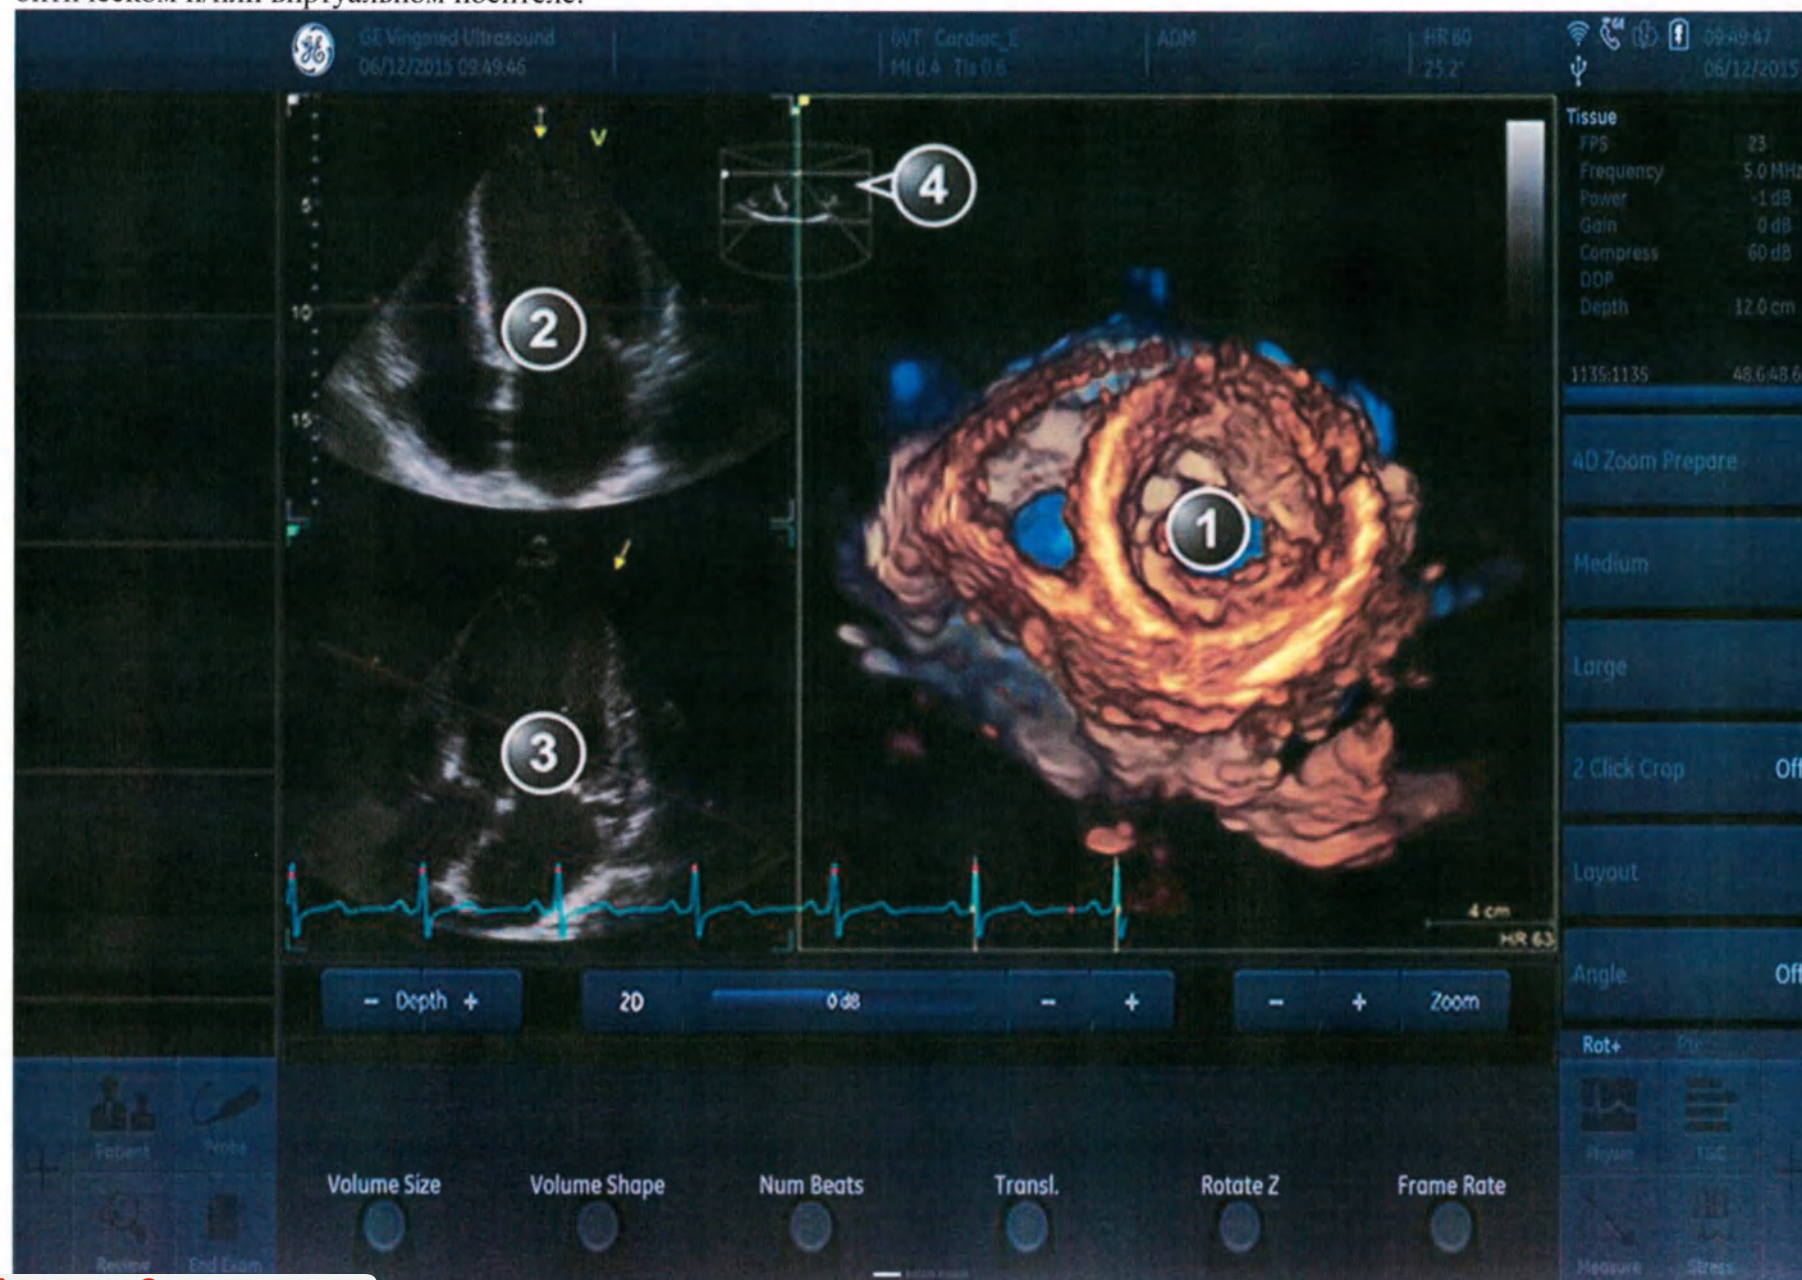


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, получения объемных ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени, анализа и обработки объемных ультразвуковых изображений на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

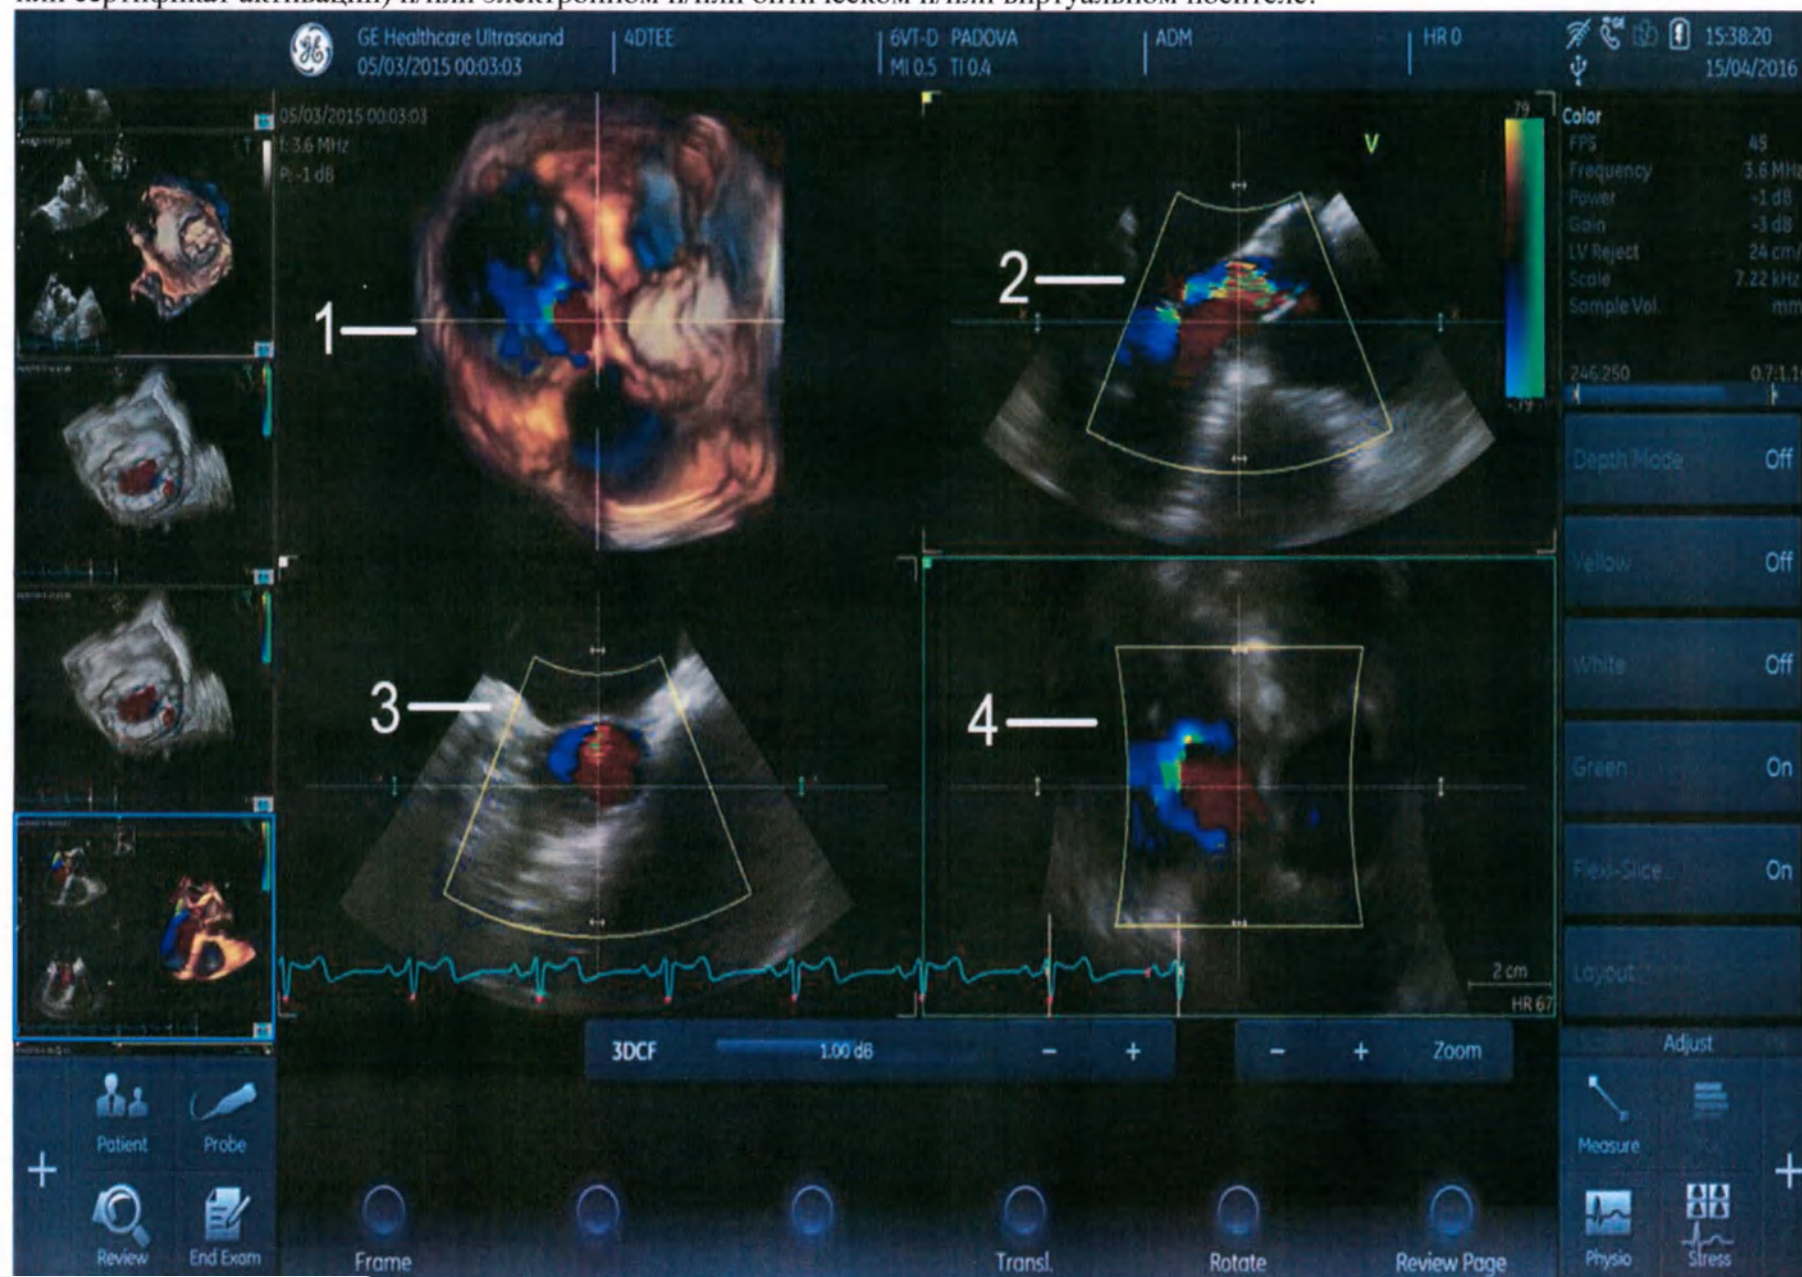


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, трехмерной реконструкции сердца и анализа данных этой реконструкции на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

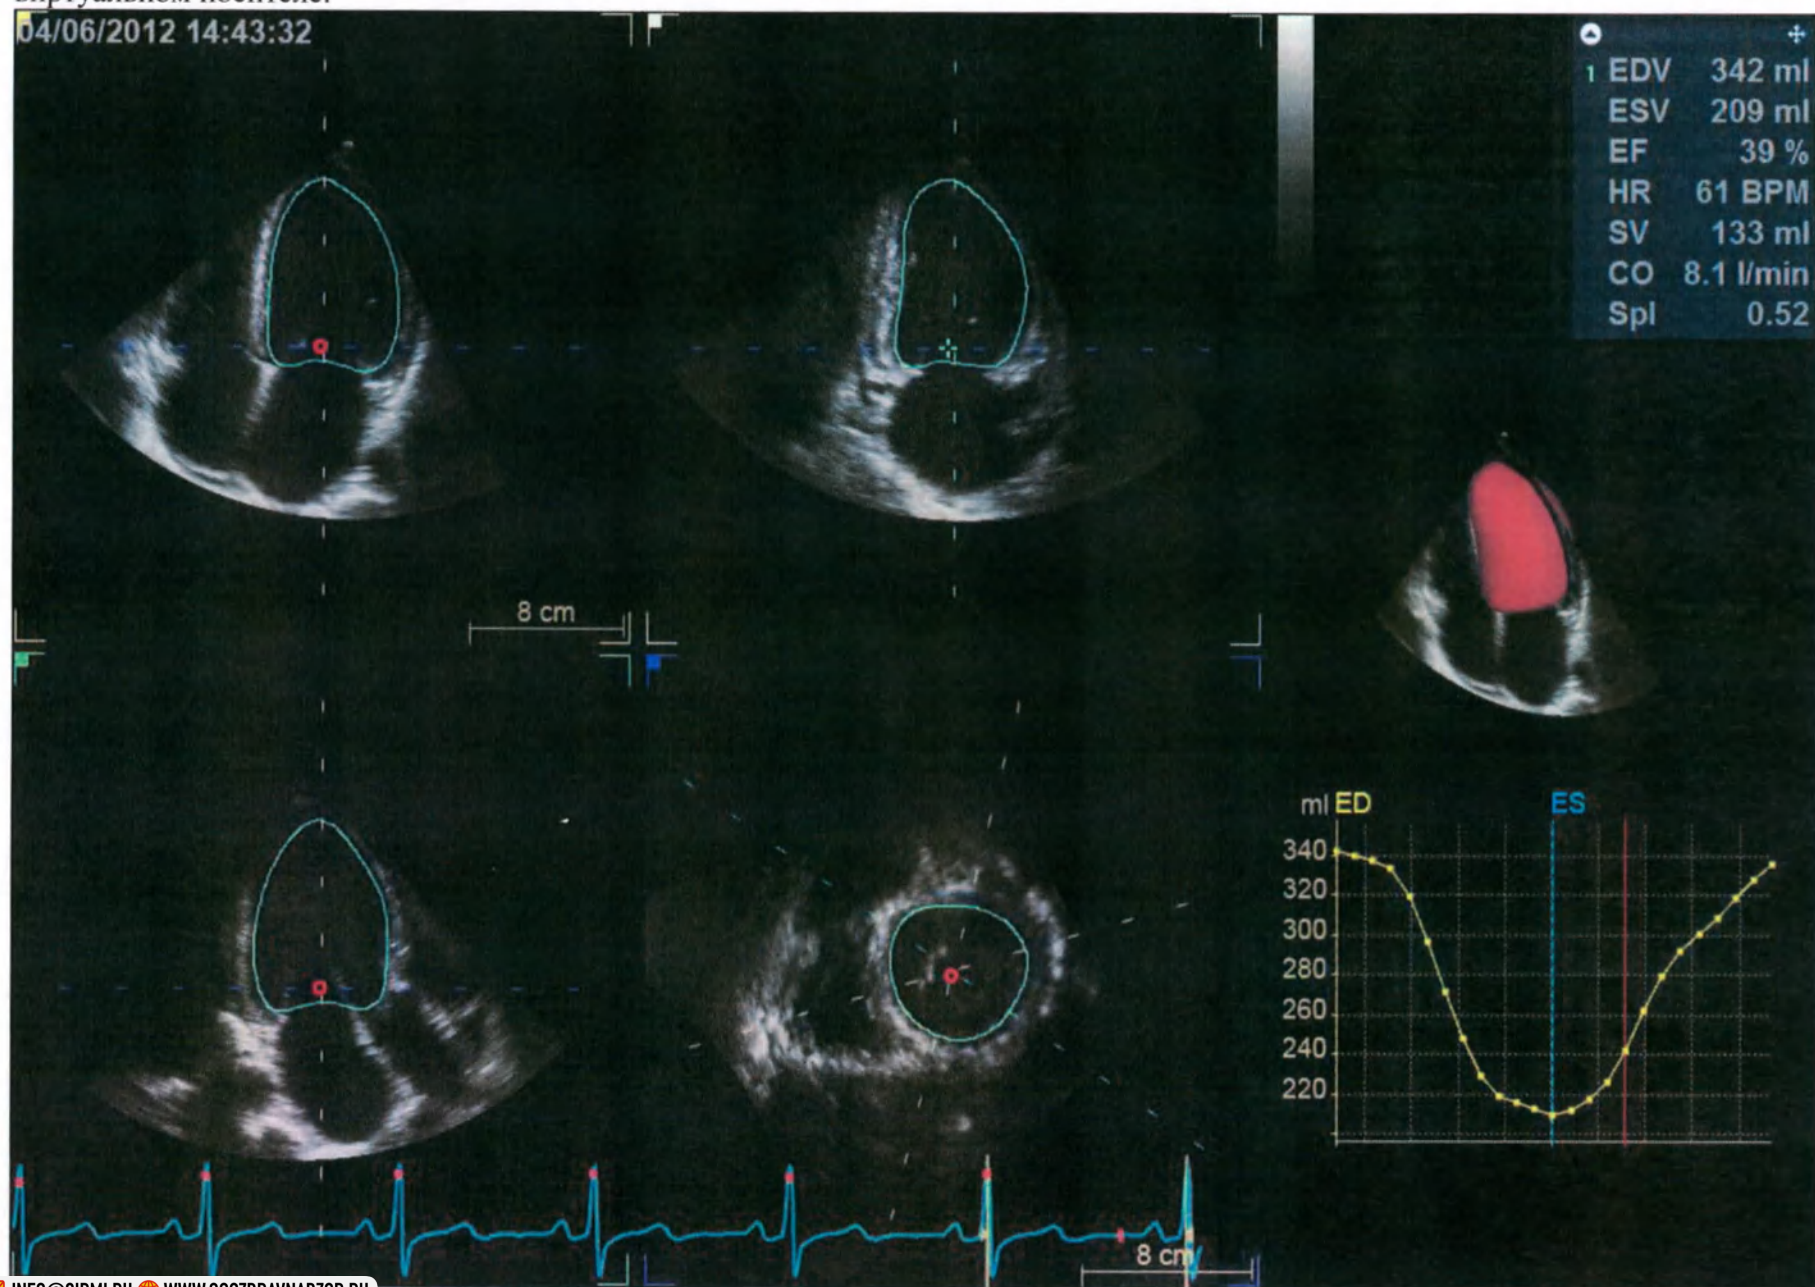


Электронный ключ для активации программного модуля для трехмерного неэхокардиографического качественного и количественного анализа глобальной сократительной функции левого желудочка и для трехмерного автоматического анализа массы миокарда левого желудочка на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

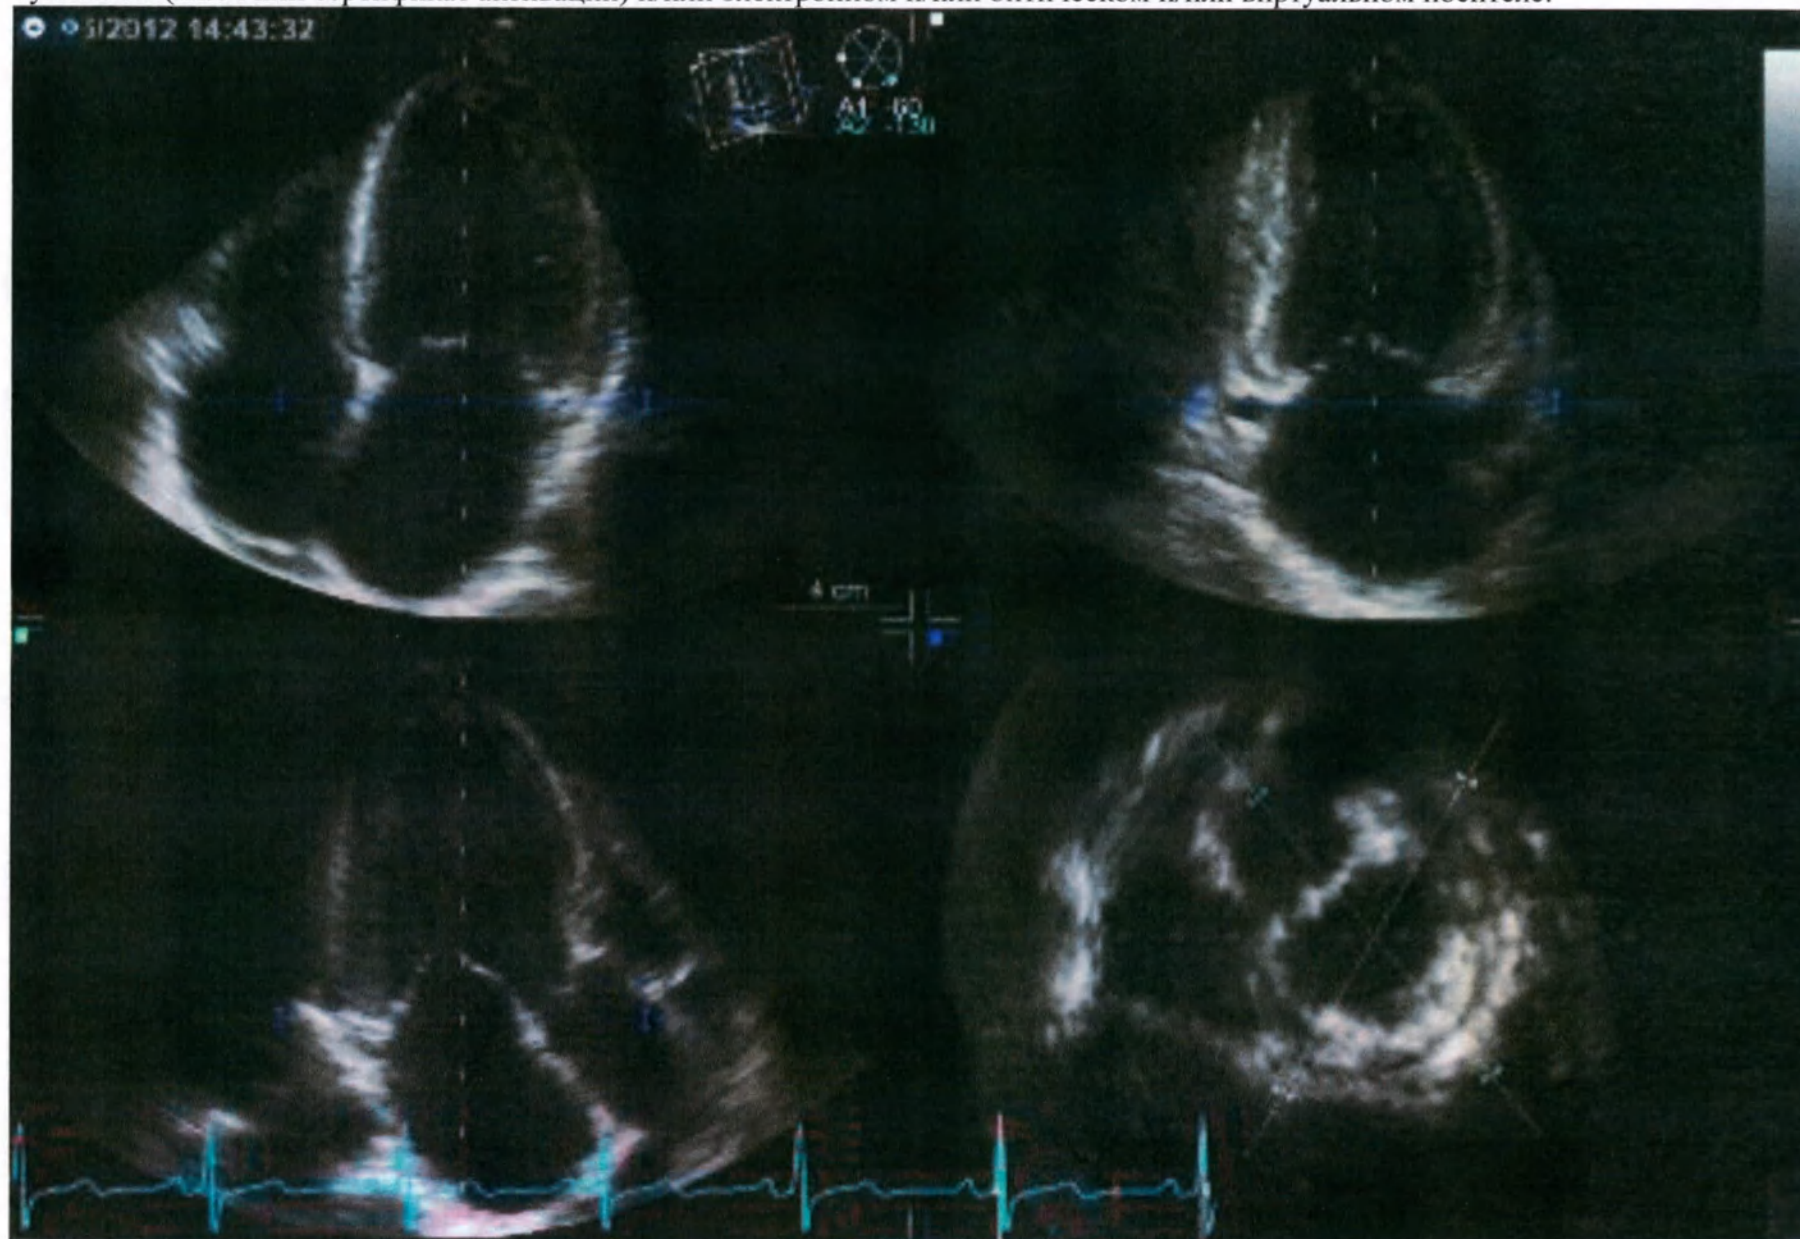


Электронный ключ для активации программного модуля для трехмерного качественного и количественного анализа и моделирования работы аортального клапана на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

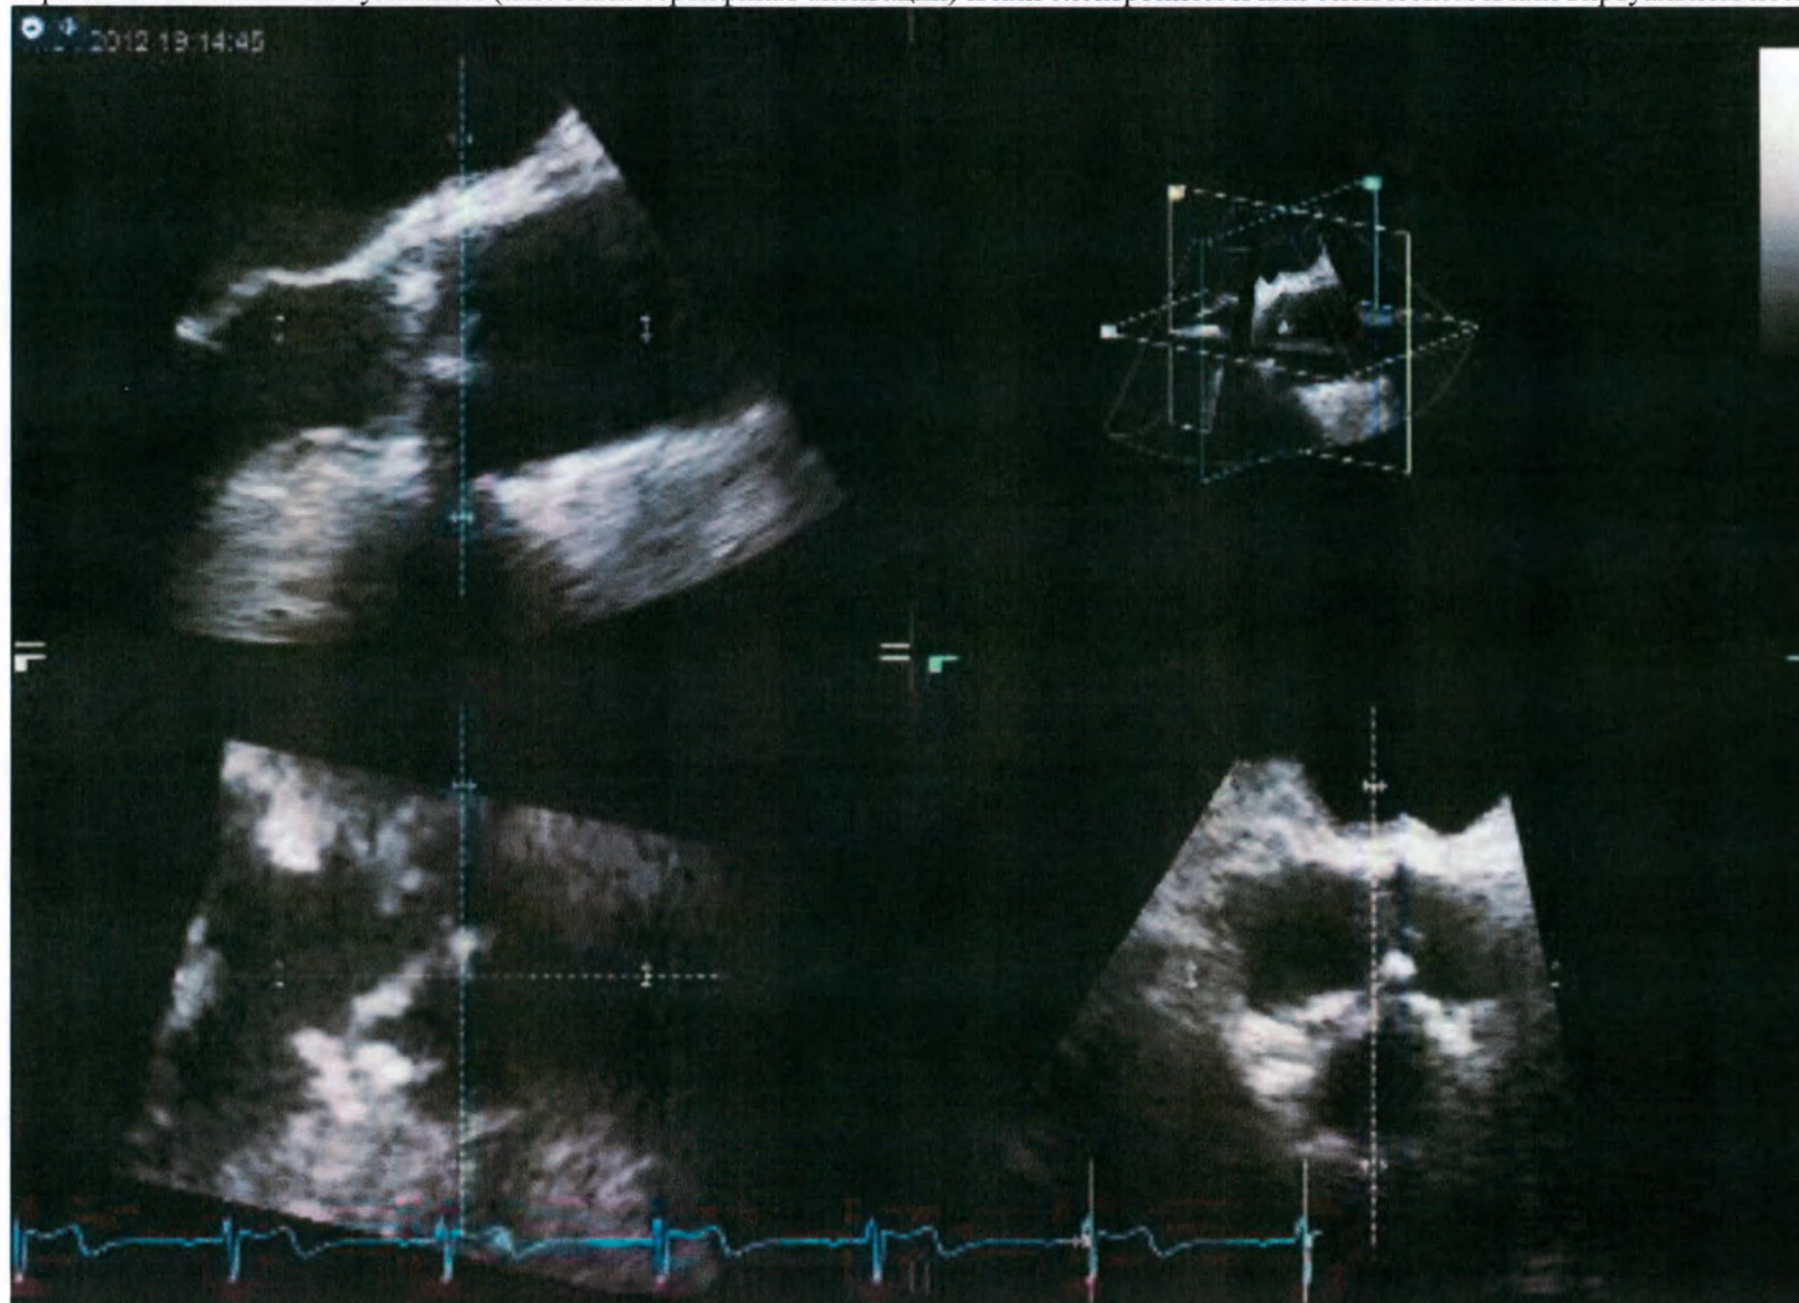


Электронный ключ для активации программного модуля для трехмерного качественного и количественного анализа и моделирования работы митрального клапана на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

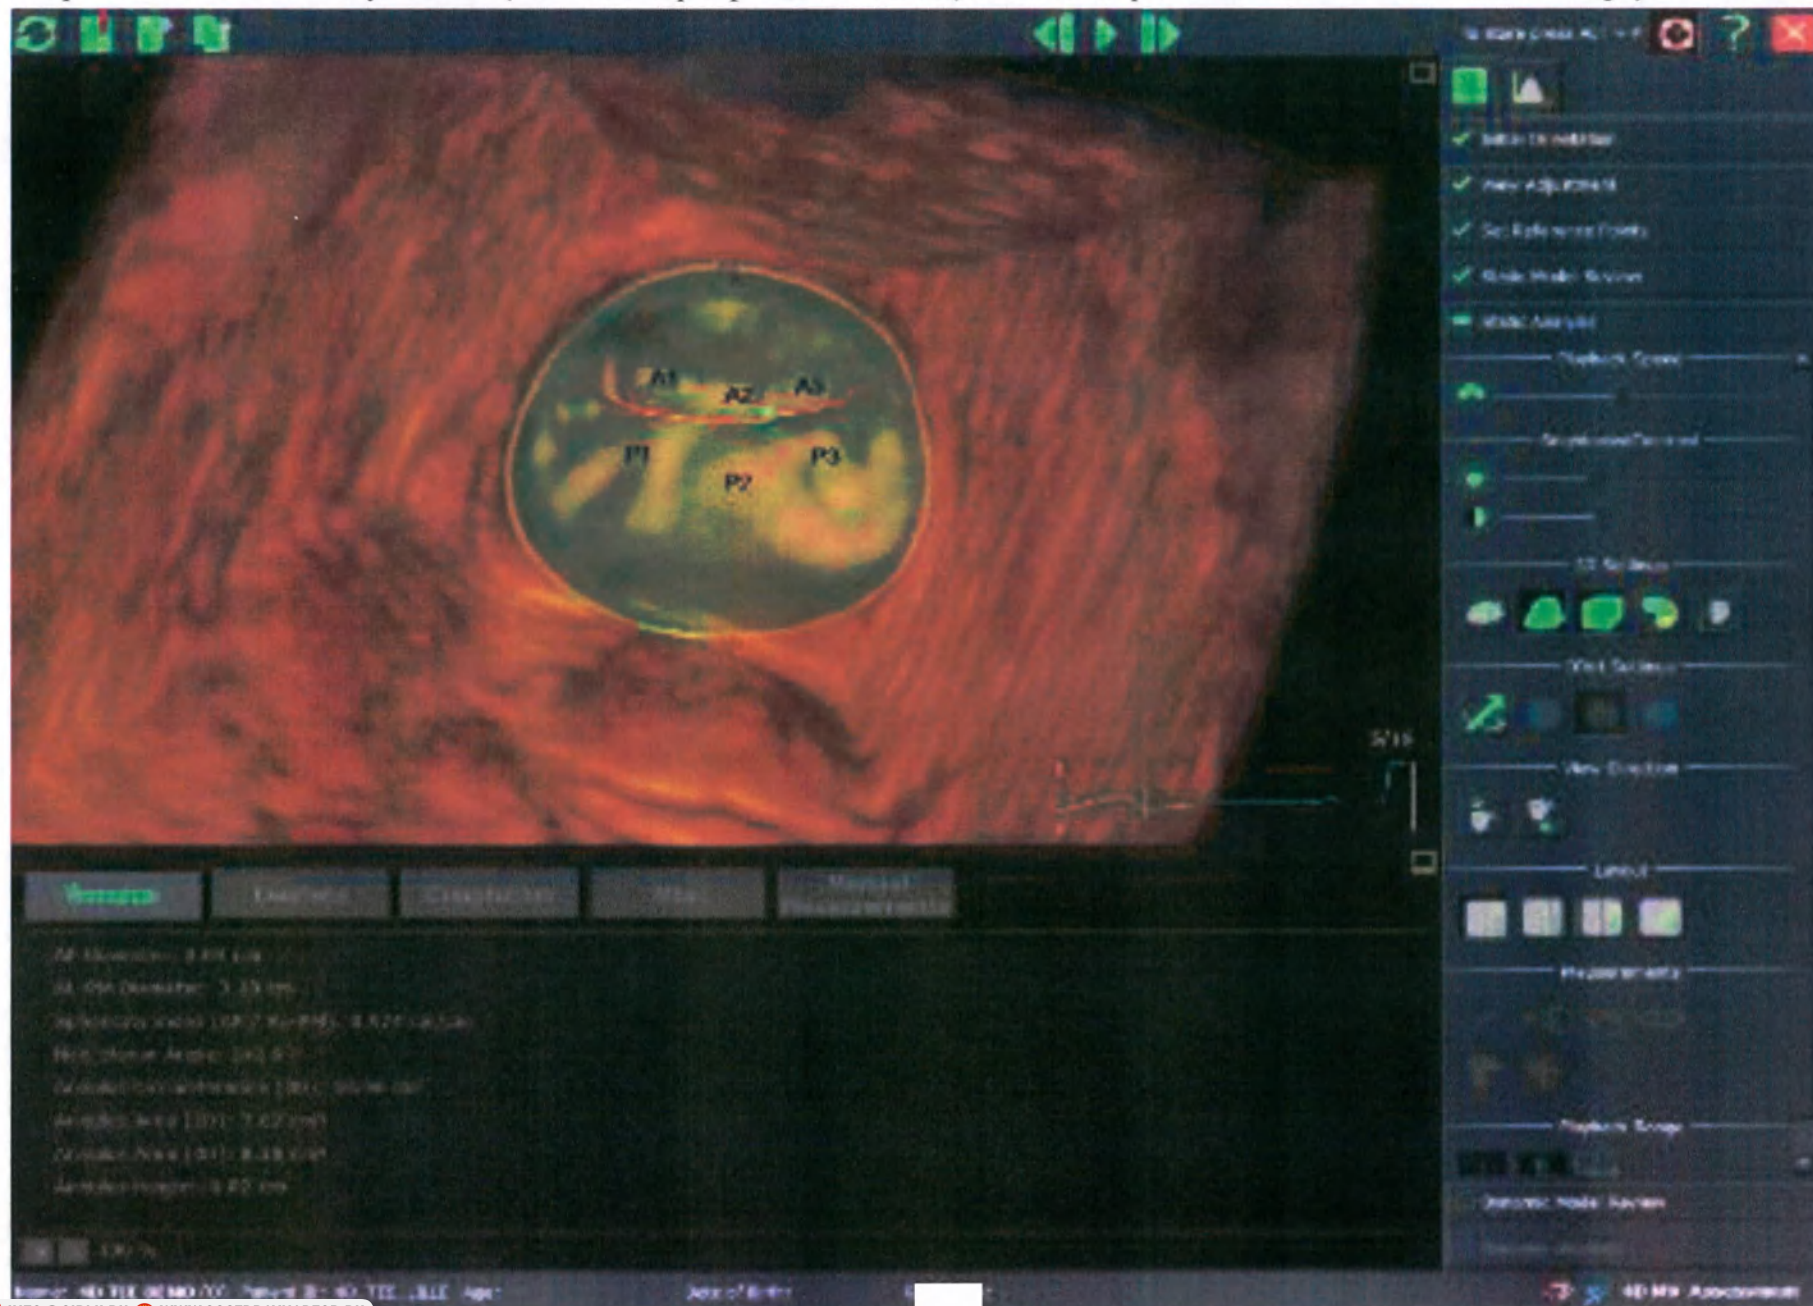


Электронный ключ для активации программного модуля для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, обработки и улучшенной визуализации данных цветового доплера в режиме 4D на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

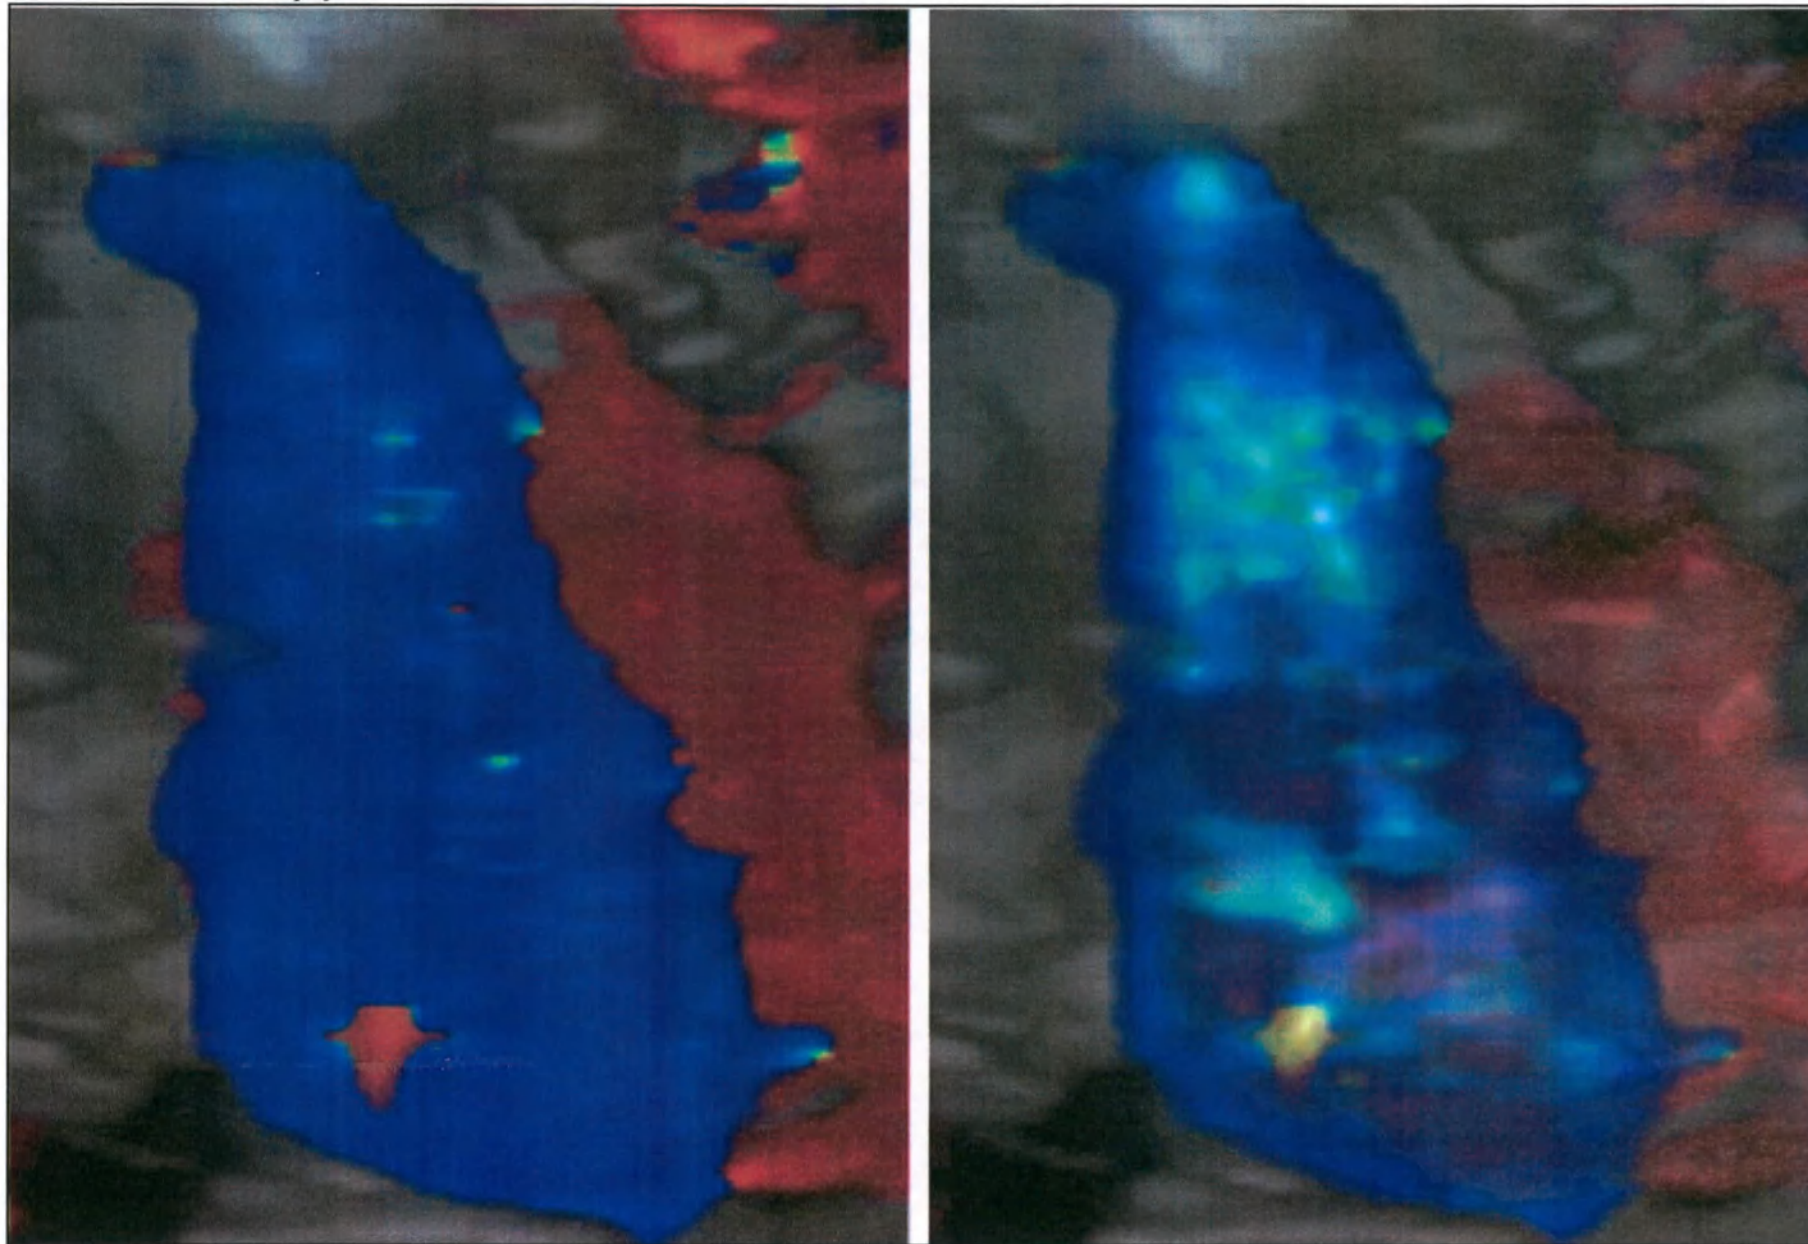


Электронный ключ для активации программного модуля для анализа, обработки и маркировки объемных данных на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

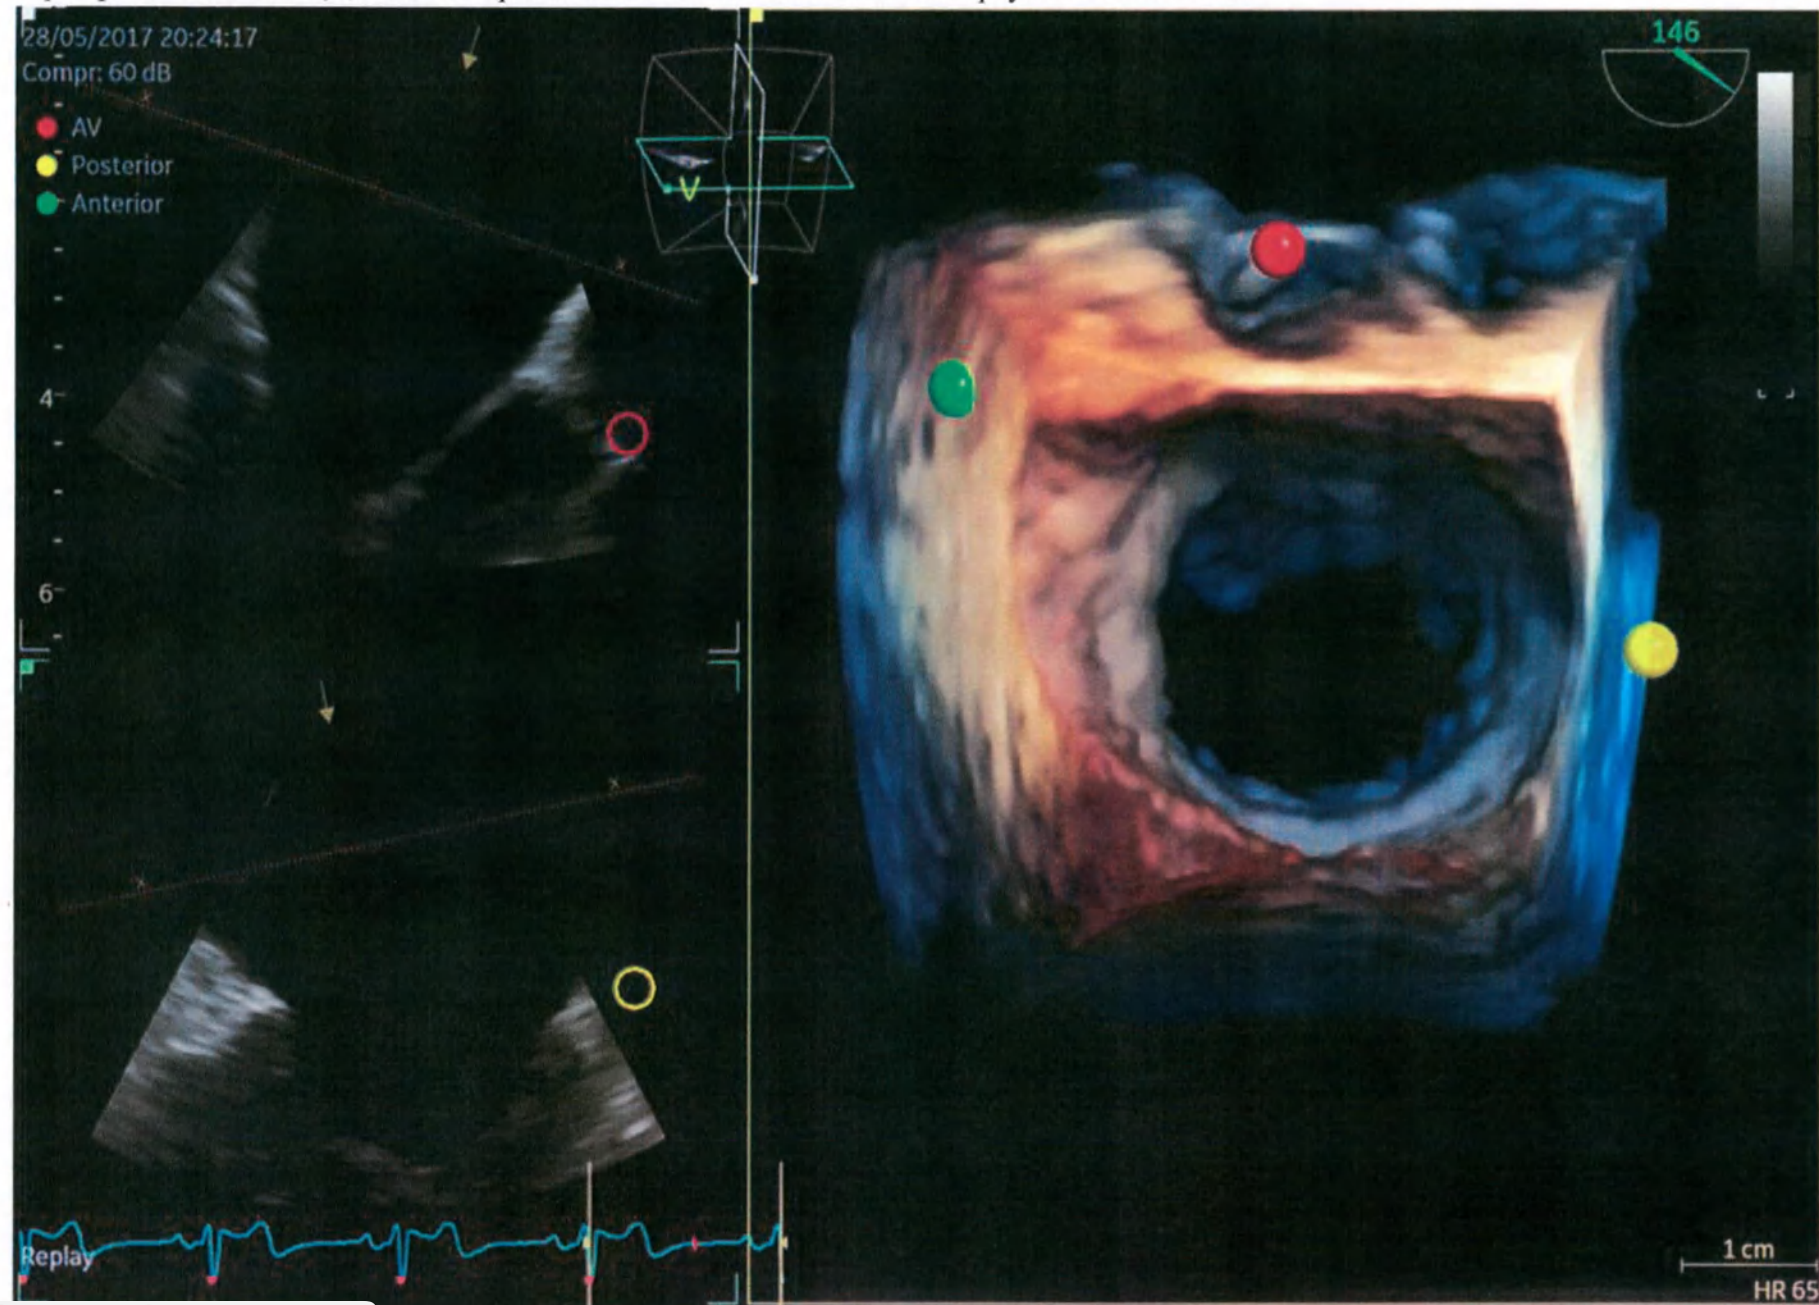


Электронный ключ для активации программного модуля поддержки работы чреспищеводного датчика в 2-D и 3-D режимах на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

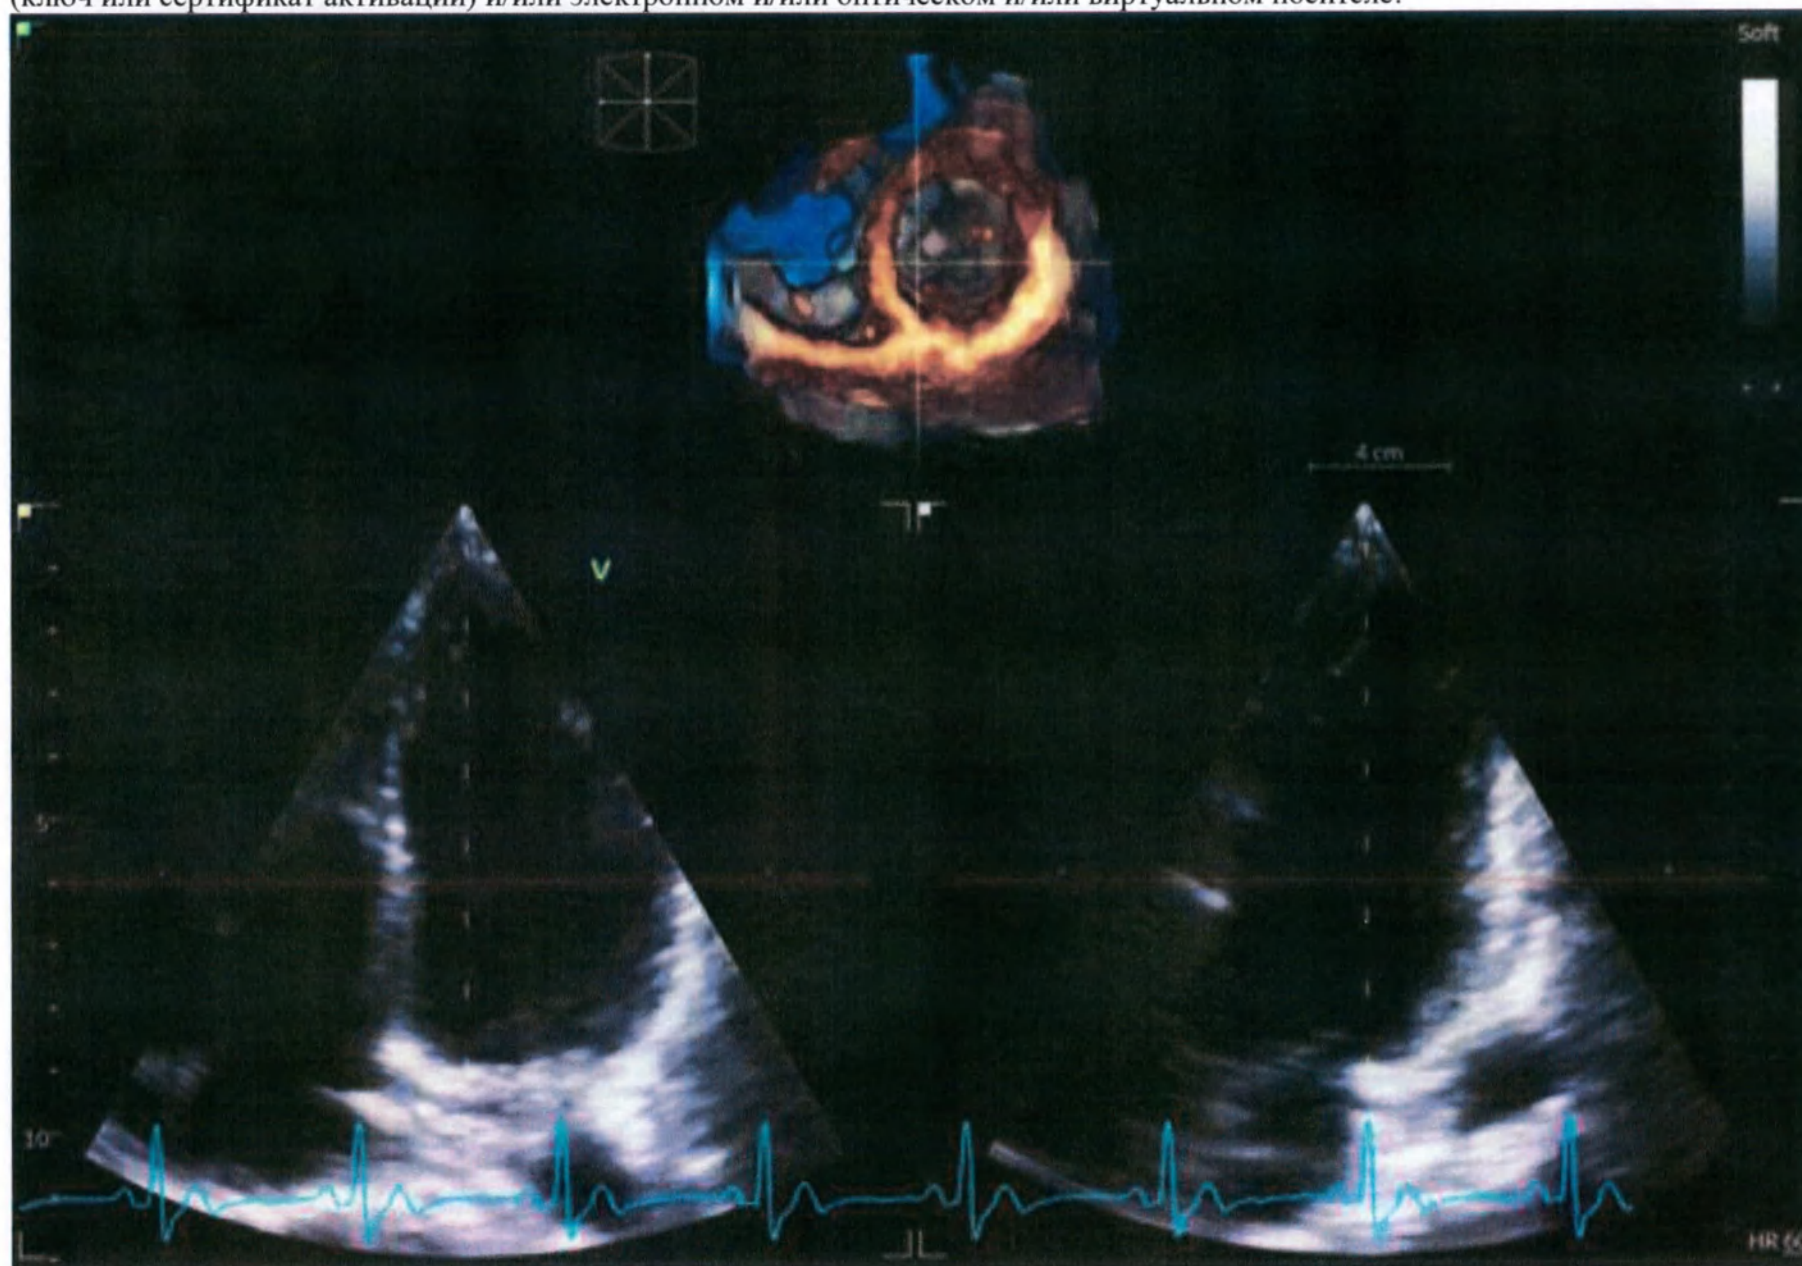


Электронный ключ для активации программного модуля автоматических доплеровских измерений в кардиологии на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

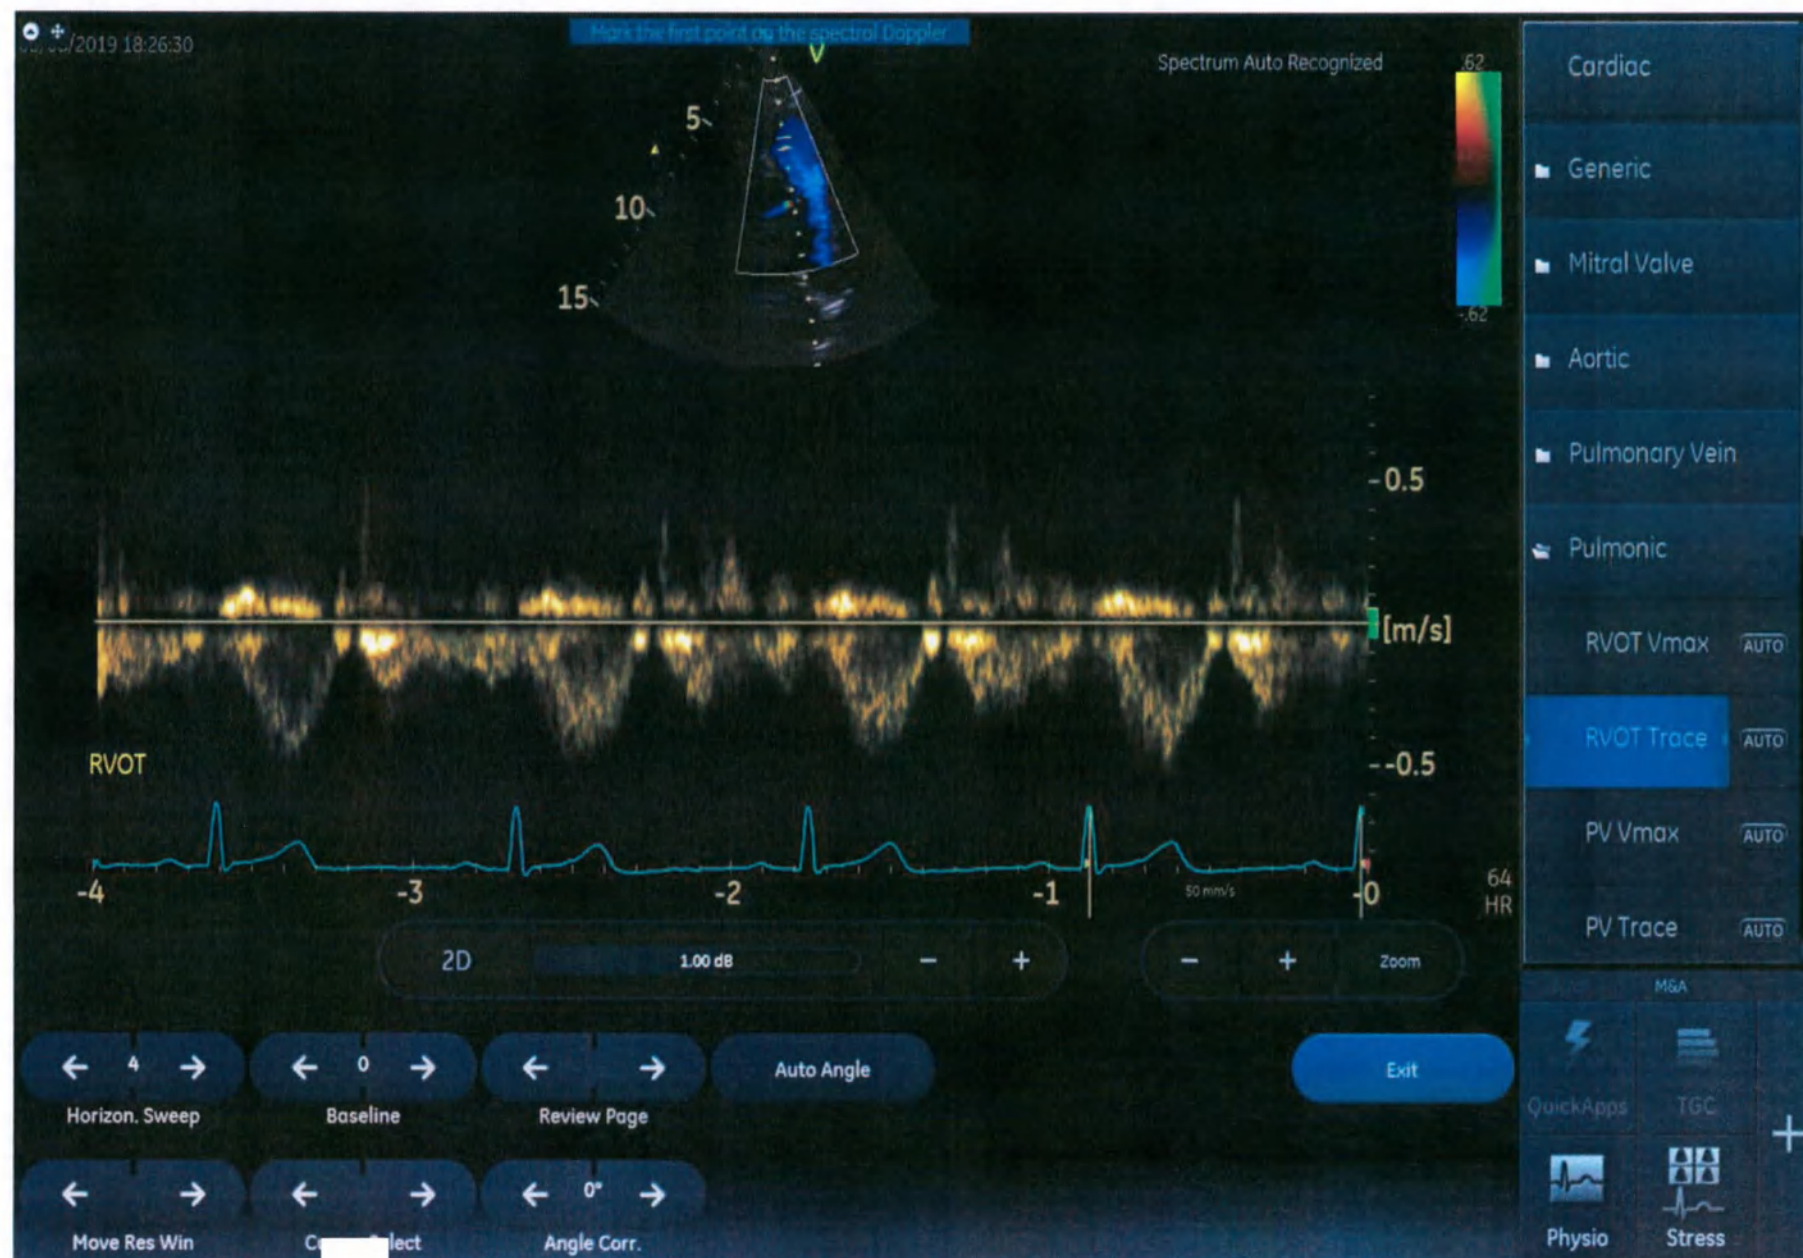


Электронный ключ для активации программного модуля для автоматического распознавания и количественного анализа двухмерных данных в кардиологии на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

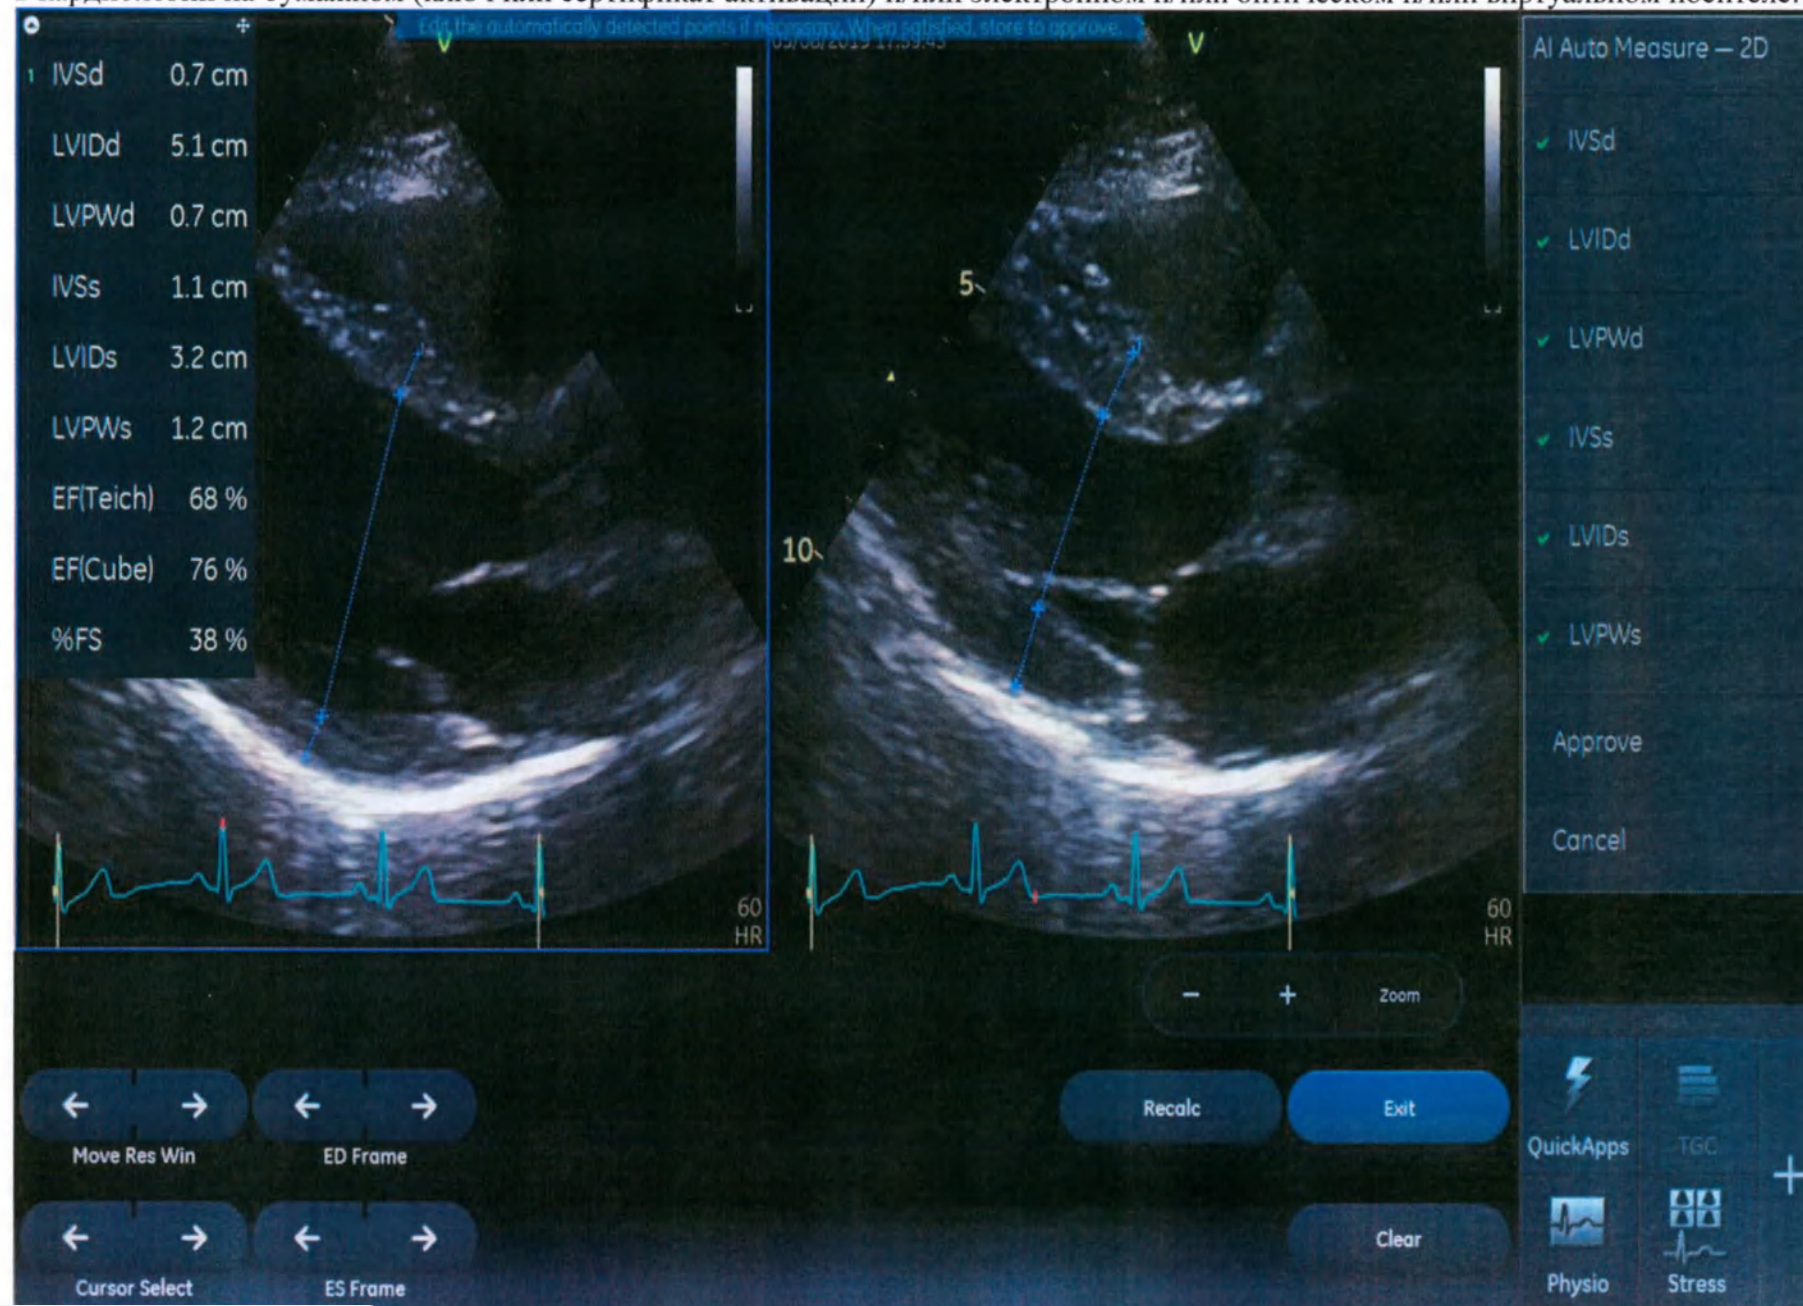

Электронный ключ для активации программного модуля для автоматического распознавания и количественного анализа доплеровского спектра на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

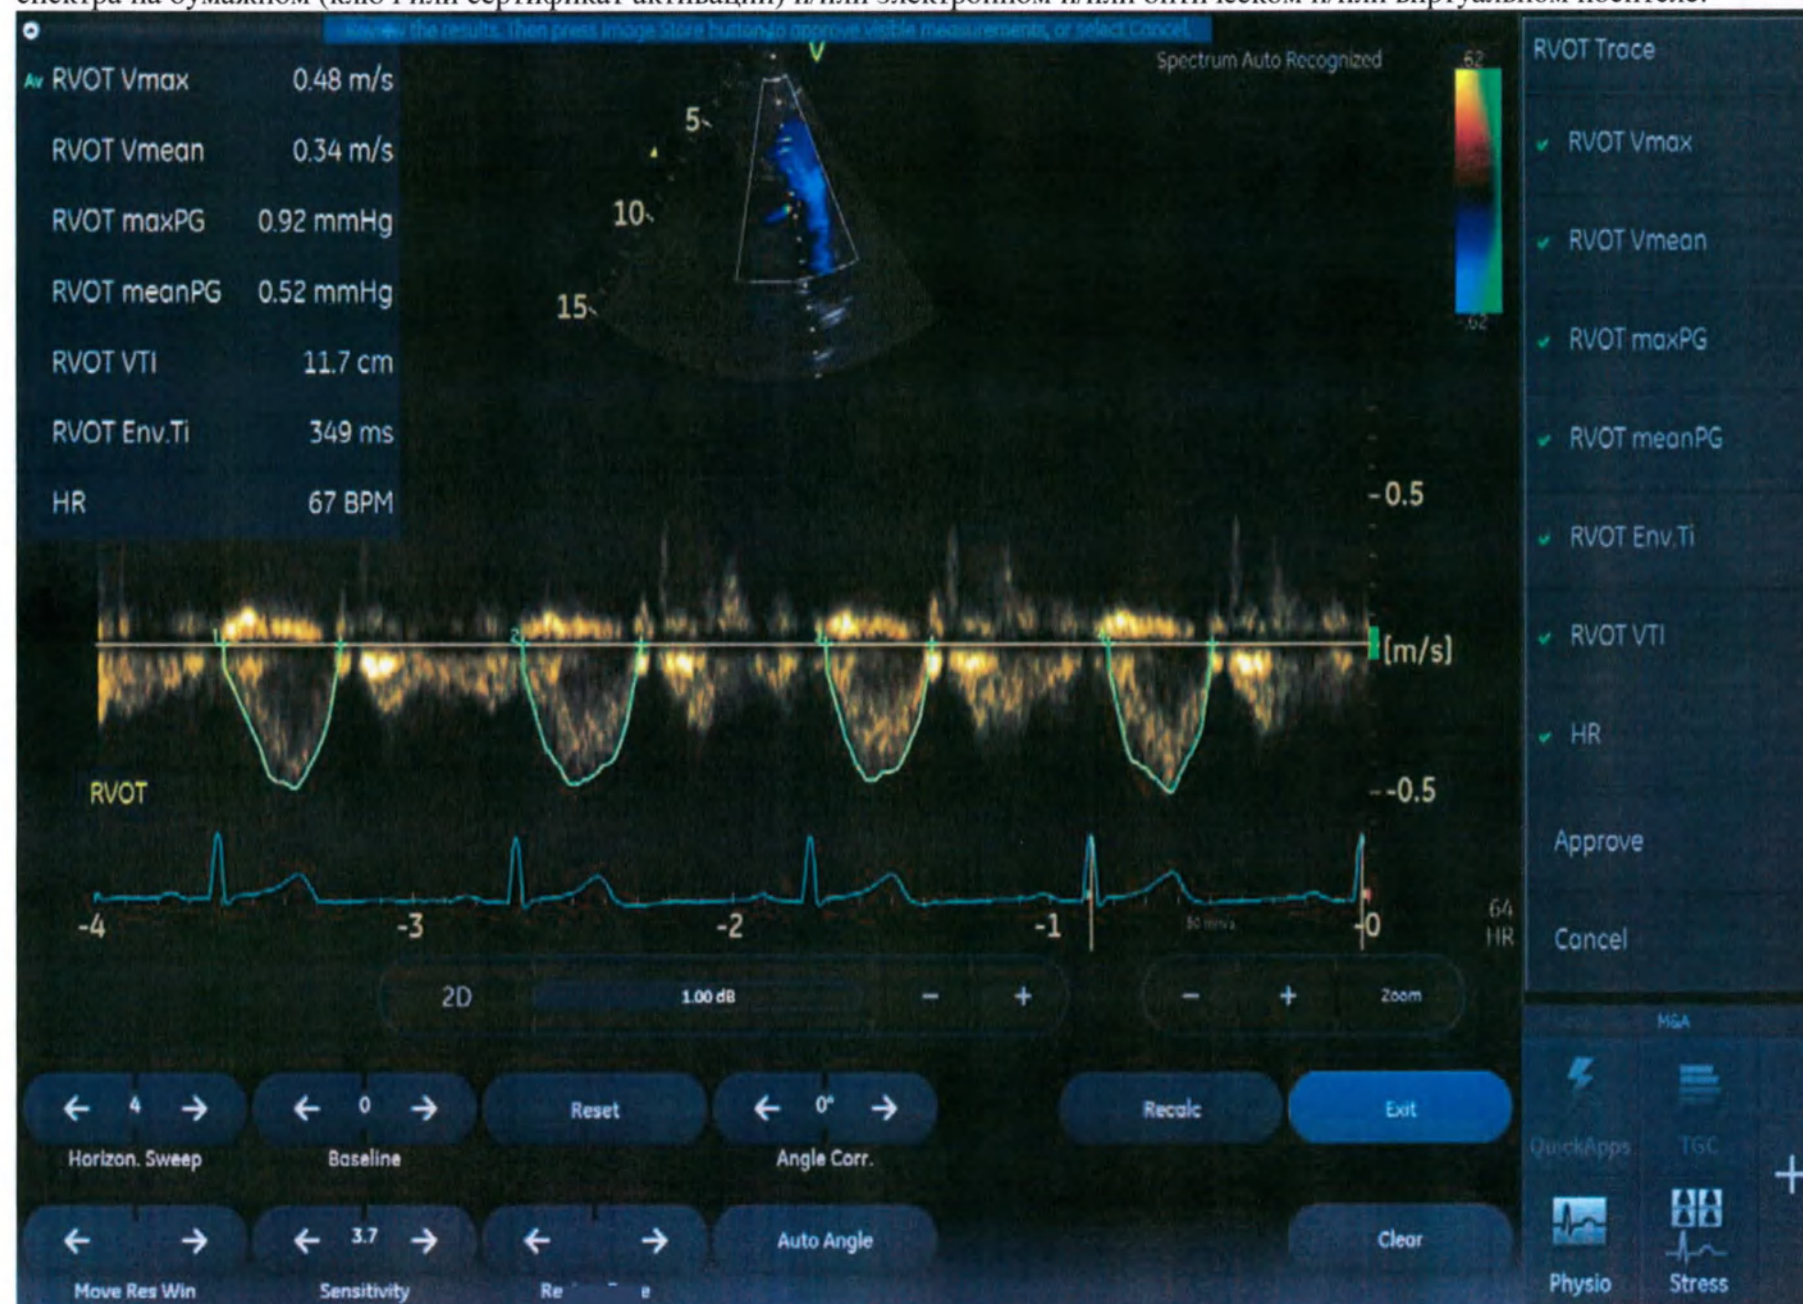

Электронный ключ для активации справочного руководства по базовым навыкам сканирования на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

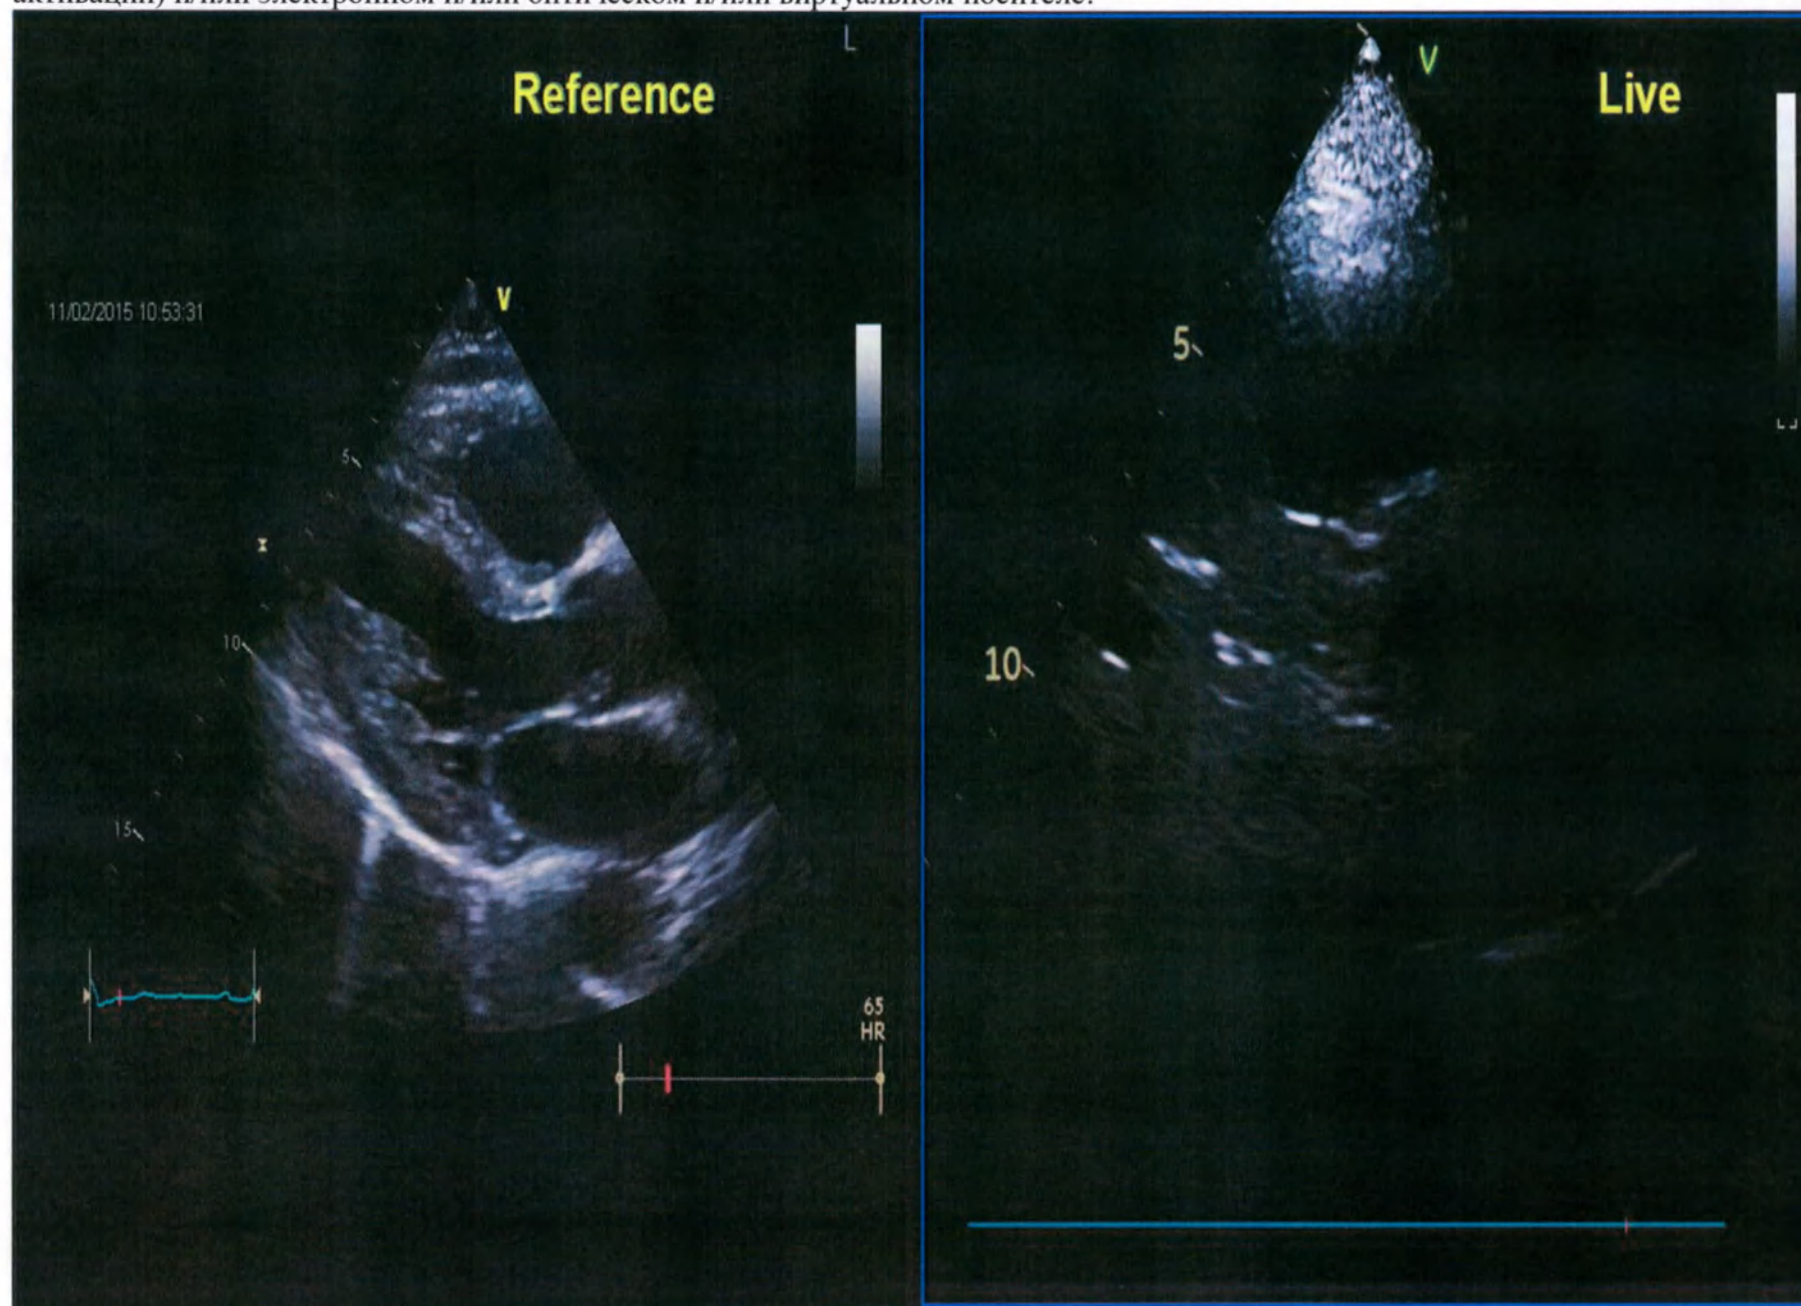

Электронный ключ для активации программного модуля для взаимодействия с сервером Qpath-E на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

Imaging	Meas/Text	Report	Connectivity	System	About				
Dataflow	Additional Outputs	Tools	TCP/IP	Remote	DICOM	Tricefy	QPath	Patient ID	Patient List

☒ Enable QPath

QView

Worksheet URL

<http://g6cr547wb0refusiongo/run/qview>

Image Server URL

<http://g6cr547wb0refusiongo/run/qview>

User

ge

Password

••••••••

Электронный ключ для активации программного модуля для хранения, обработки и передачи данных в цифровом медицинском формате DICOM 3 на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

[Назад к скан.](#)  GE Vingmed Ultrasound | | | ADM |

Изображение

Измерения

Отчет

Связность

Система

О приложении

Администриров...

Сервис

Поток данных

Дополнительные устр-ва вывода

Инструменты

TCP/IP

Удален.

DICOM

ID пациента

Список пациентов

Управление диском

Другие

DICOM

DICOM images

Назв. станции

Viq-6105102WX0

AE Title

Viq-6105102WX0

Порт No

104

☒ Эхо-запрос ICMP (проверка связи)

☐ Подробный DICOM Log

☒ Показать значок необр. данных

☐ Показ. предупрежд. об ошибке формата в раб. списке

☒ Нет дополнительных сведений

☐ Добавить инф-цию пациента в изобр-ния DICOM

☐ Добавить строку заголовка

☒ Использовать высокое разрешение DICOM


Настройка цвета

Оптимизировано для Gamma 2.2

Формат изображения

Средний


Электронный ключ для активации программного модуля для доступа к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

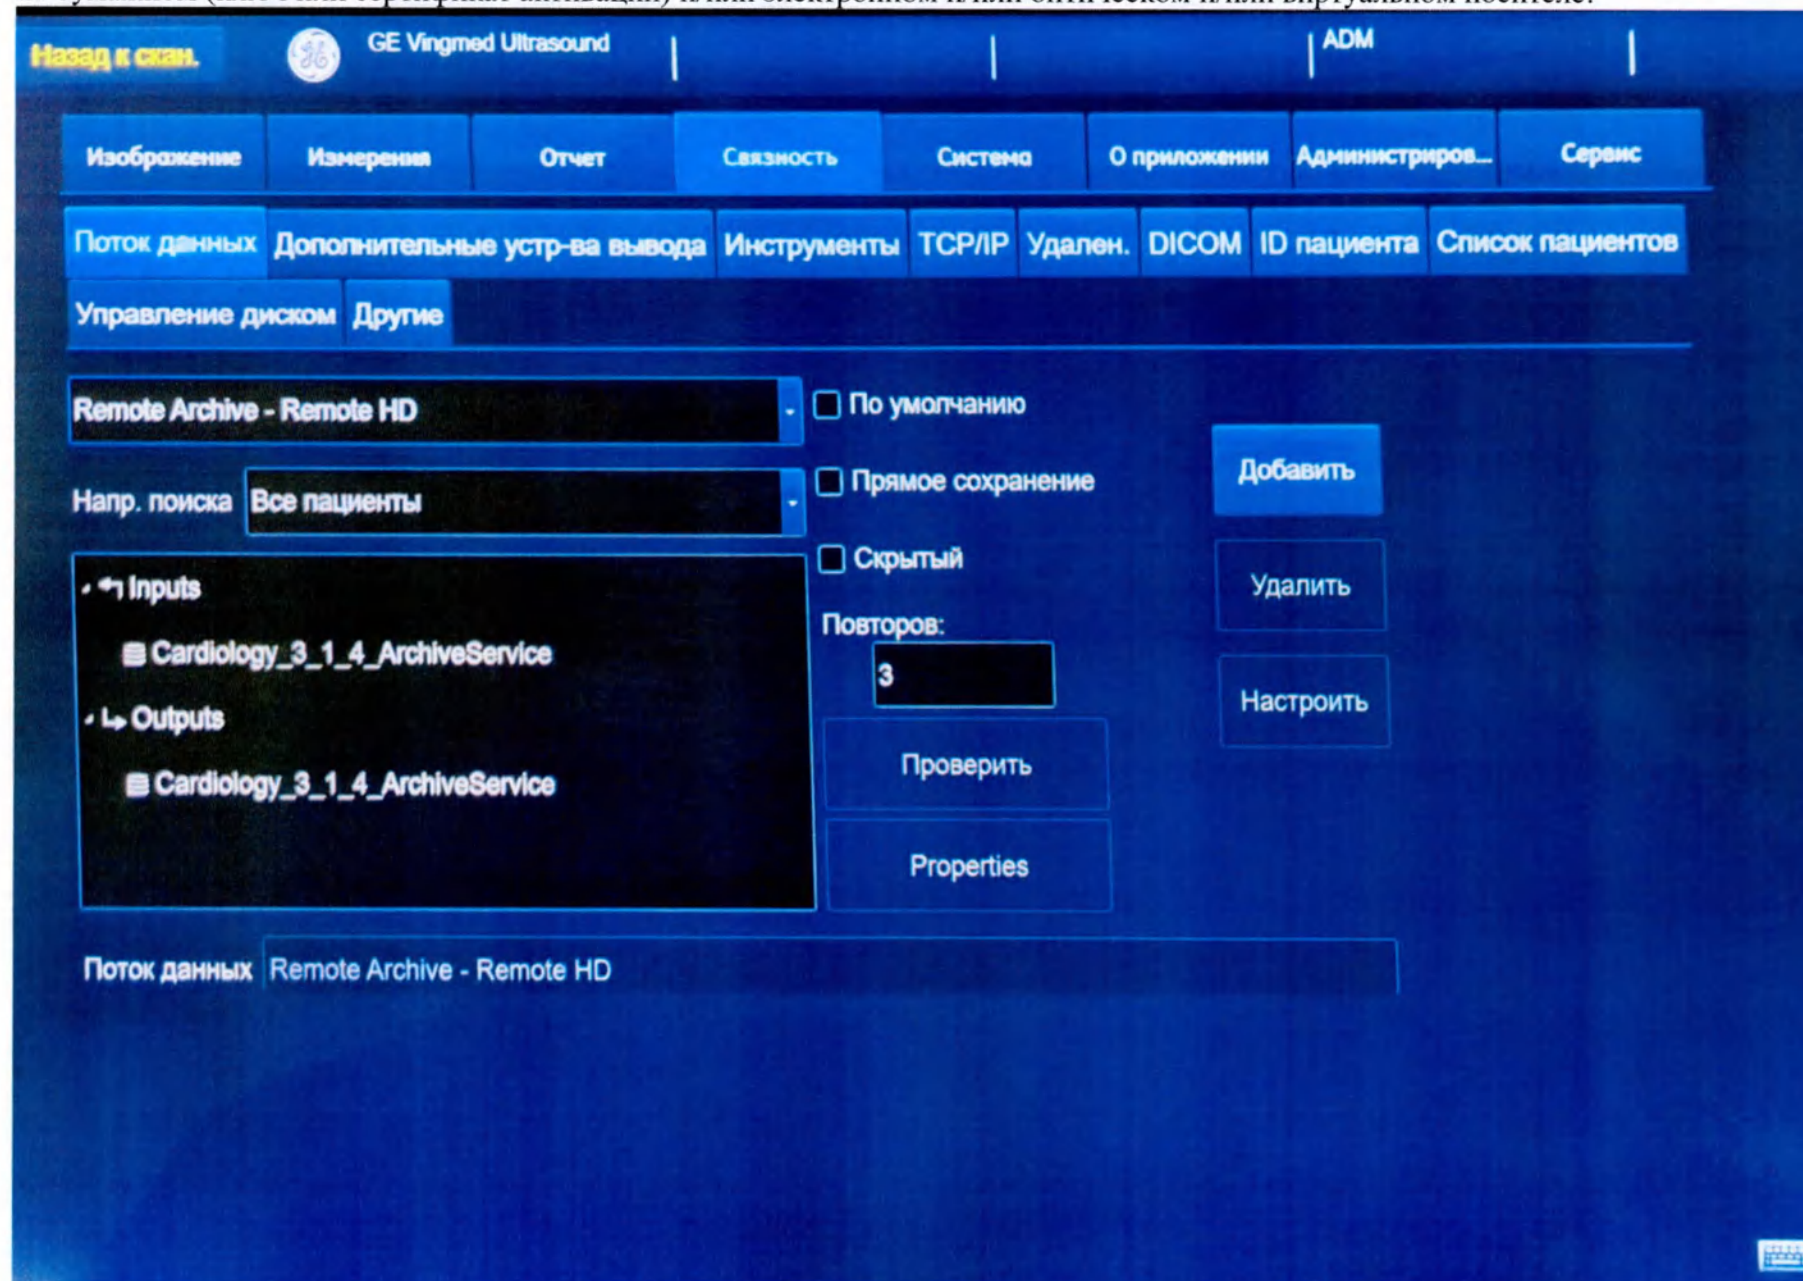

Электронный ключ для активации программного модуля для печати на DICOM принтере на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

DICOM						
#	Last Name	Patient ID	Destination	Type	Contents	Size
1	Doe	112211	DICOM Storage	Storage	2	0

Электронный ключ для активации программного модуля для записи информации на сменные носители информации (CD, DVD, USB-flash, UDO-media) на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

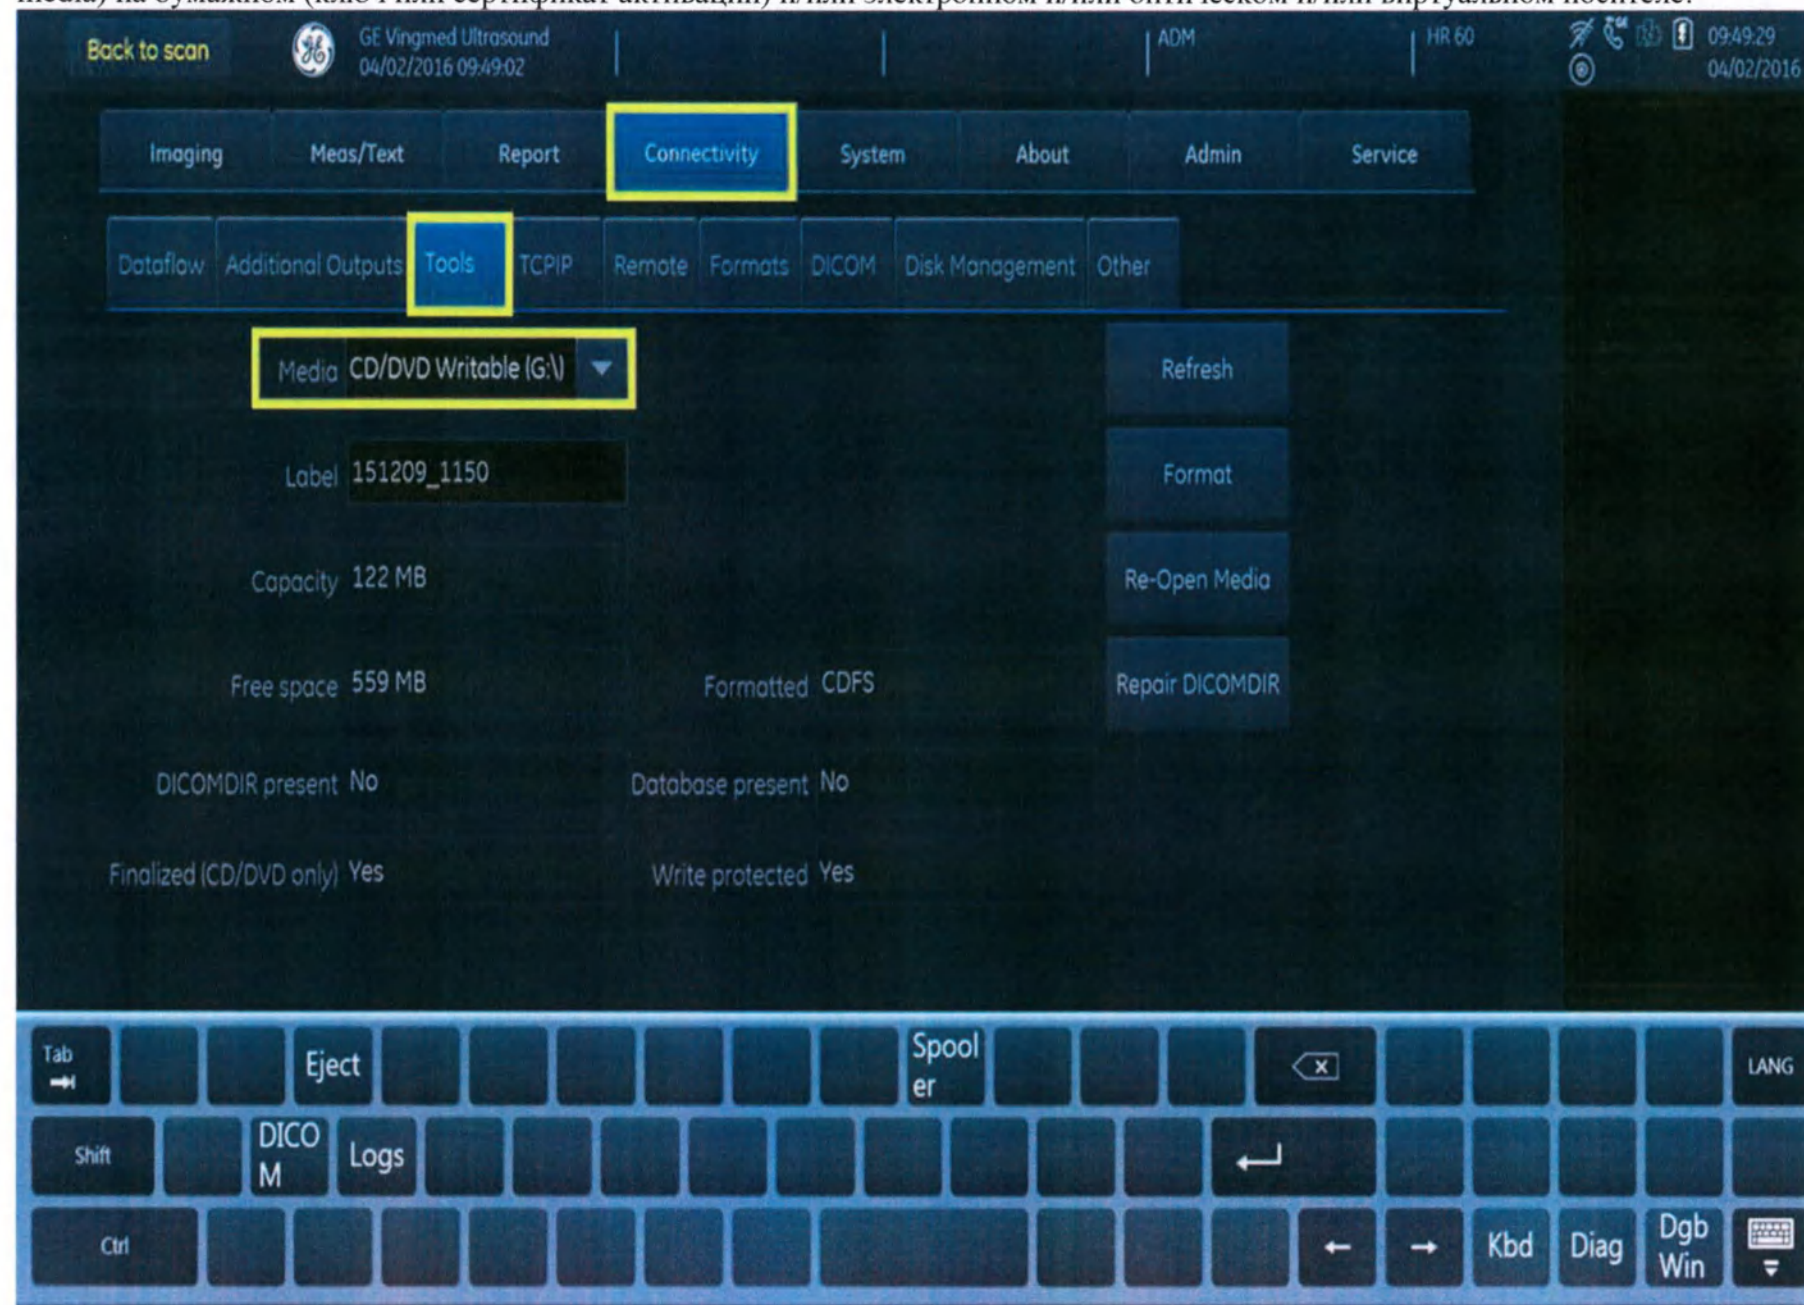

Электронный ключ для активации программного модуля для записи и сохранения информации со встроенным просмотрщиком на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

[Назад к скан.](#)  GE Vingmed Ultrasound | ADM

DicomMedia - (SCMediaStorage)

IP-адрес (Viq-6105102WX0) 127.0.0.1 + Проверить

Имя DICOM CD/DVD

Местоположение \\127.0.0.1\CDRW

Тип R/W

Настройки изображения

Макс част.кадров Full ☐ Разрешить Raw Data

Компрессия Jpeg ☐ Raw Сжат.

Качество % 95 ☒ Разрешить Многокадрово

☐ Многокадровый режим с динамикой движения во времени

☐ Только черно/белый

Dicom SR установки

☐ Позволяет SR

☐ Позволяет SR Персональные Данные

☐ Нет изображений

☐ Допплеровские скорости со знаком


☐ Использовать более старую версию SR

Ср-во просмотра DICOM

☒ Добавить ср-во просм. Dicom

OK Отмена

Электронный ключ для активации программного модуля для беспроводной передачи информации на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

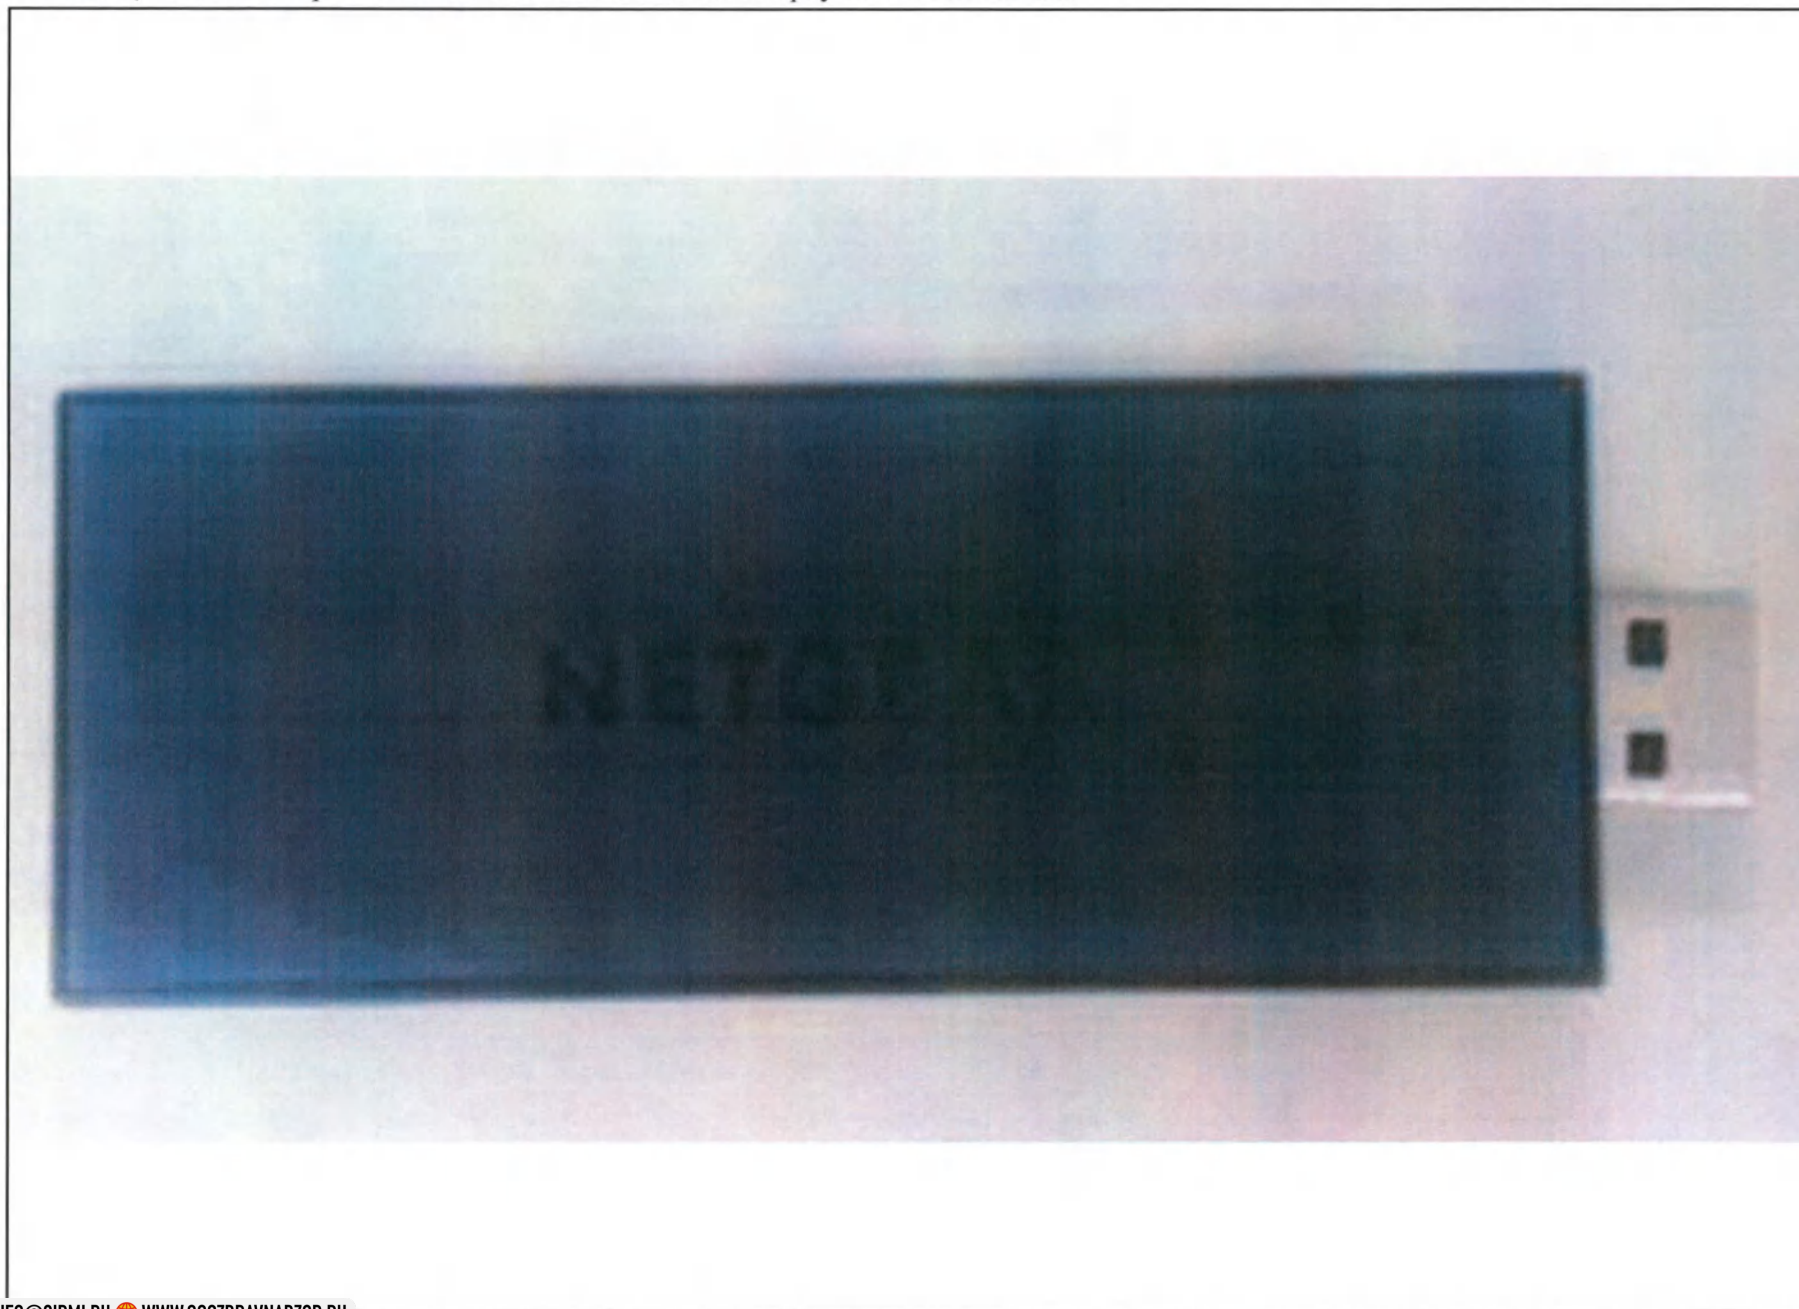

USB модуль для беспроводной связи аппарата с компьютерными сетями.



Электронный ключ для активации программного модуля для формирования и печати отчетов на принтере на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

Page Setup

Paper

Size: Default

Margins (millimeters)

Left	25.4	Right	25.4
Top	25.4	Bottom	25.4

Orientation

☒ Portrait


☐ Landscape

Header and footer


Header: {pnm}{c}{pid}{r}Page {cp} of {tp}

Footer: {ext} {r} Print date: {prdt}


Электронный ключ для активации программного модуля для потоковой передачи видеоданных на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

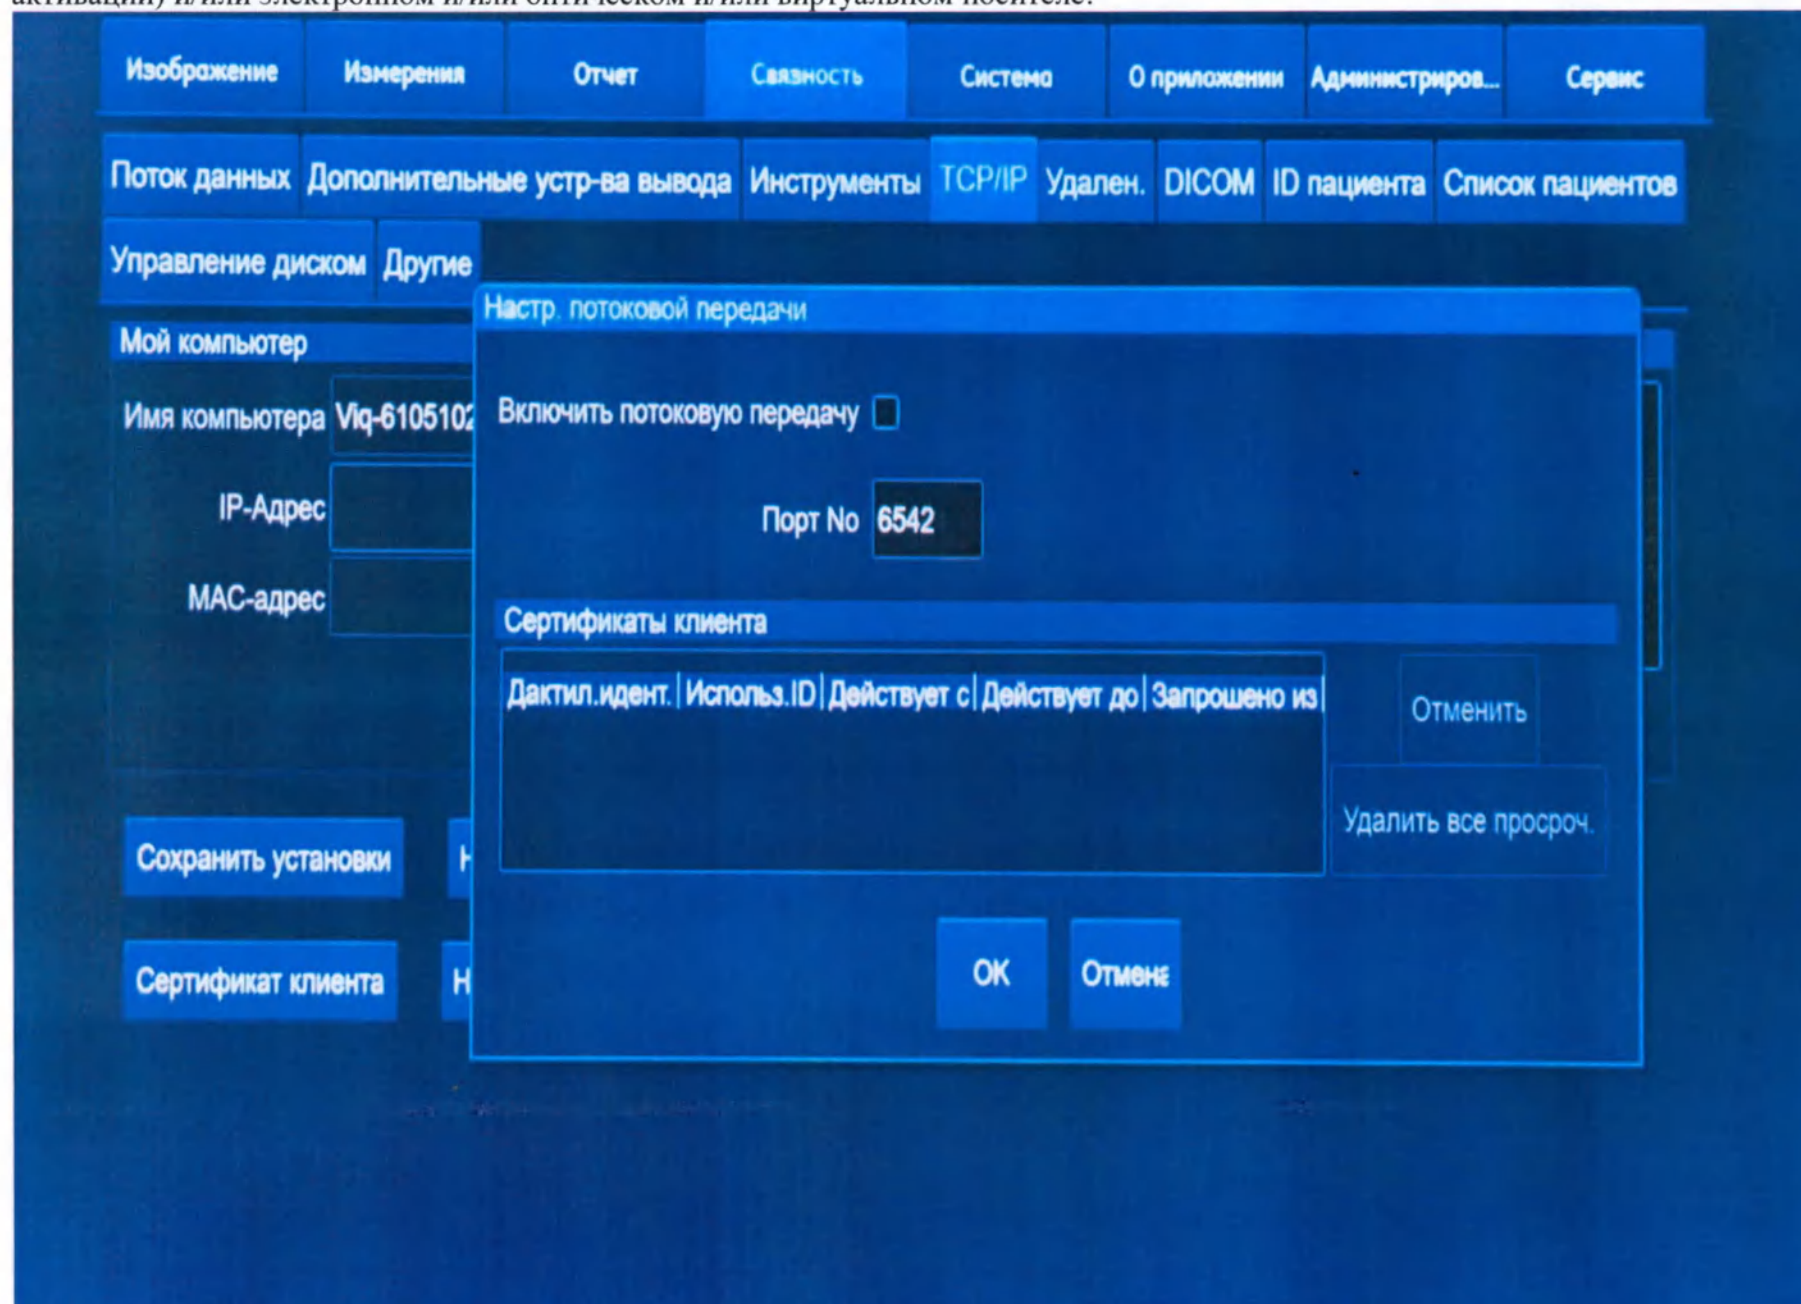


Электронный ключ для активации встроенной функции для обеспечения удаленного доступа к сервисной поддержке в режиме онлайн eDelivery на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

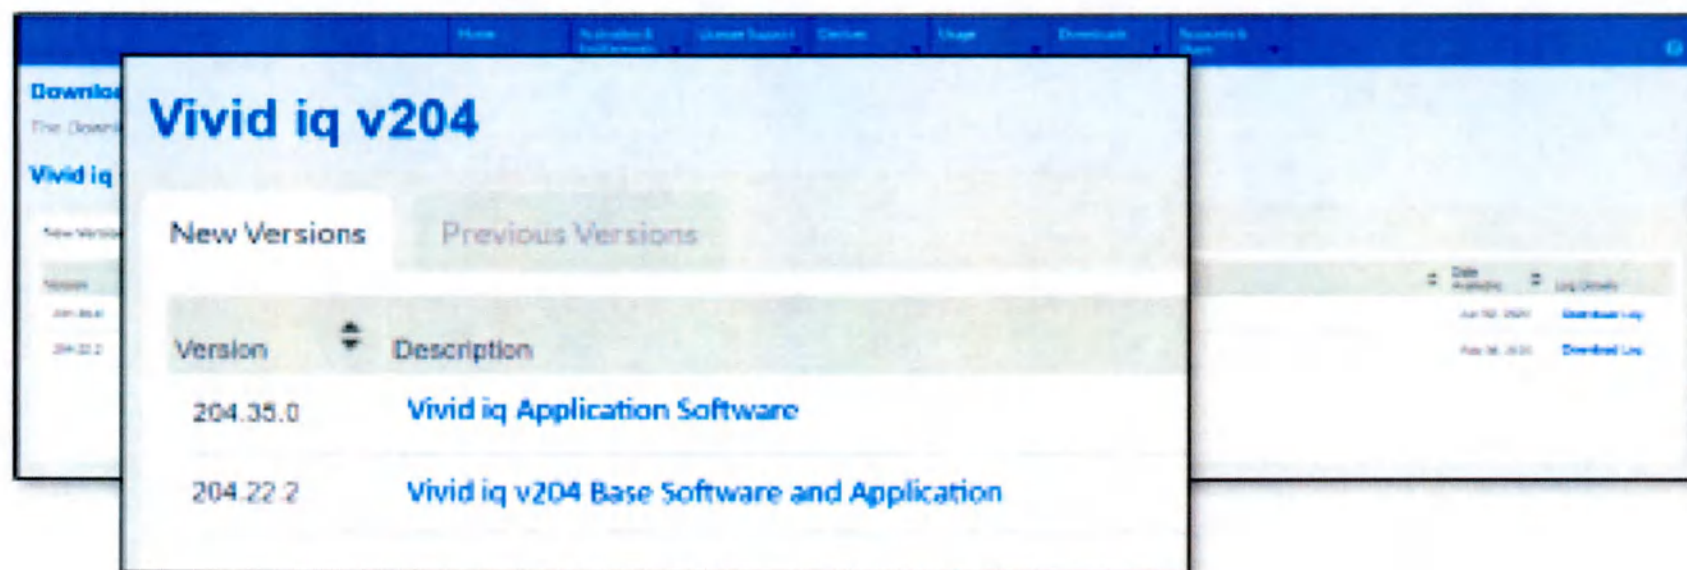


Электронный ключ для активации программного модуля огибающего анатомического М-режима на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

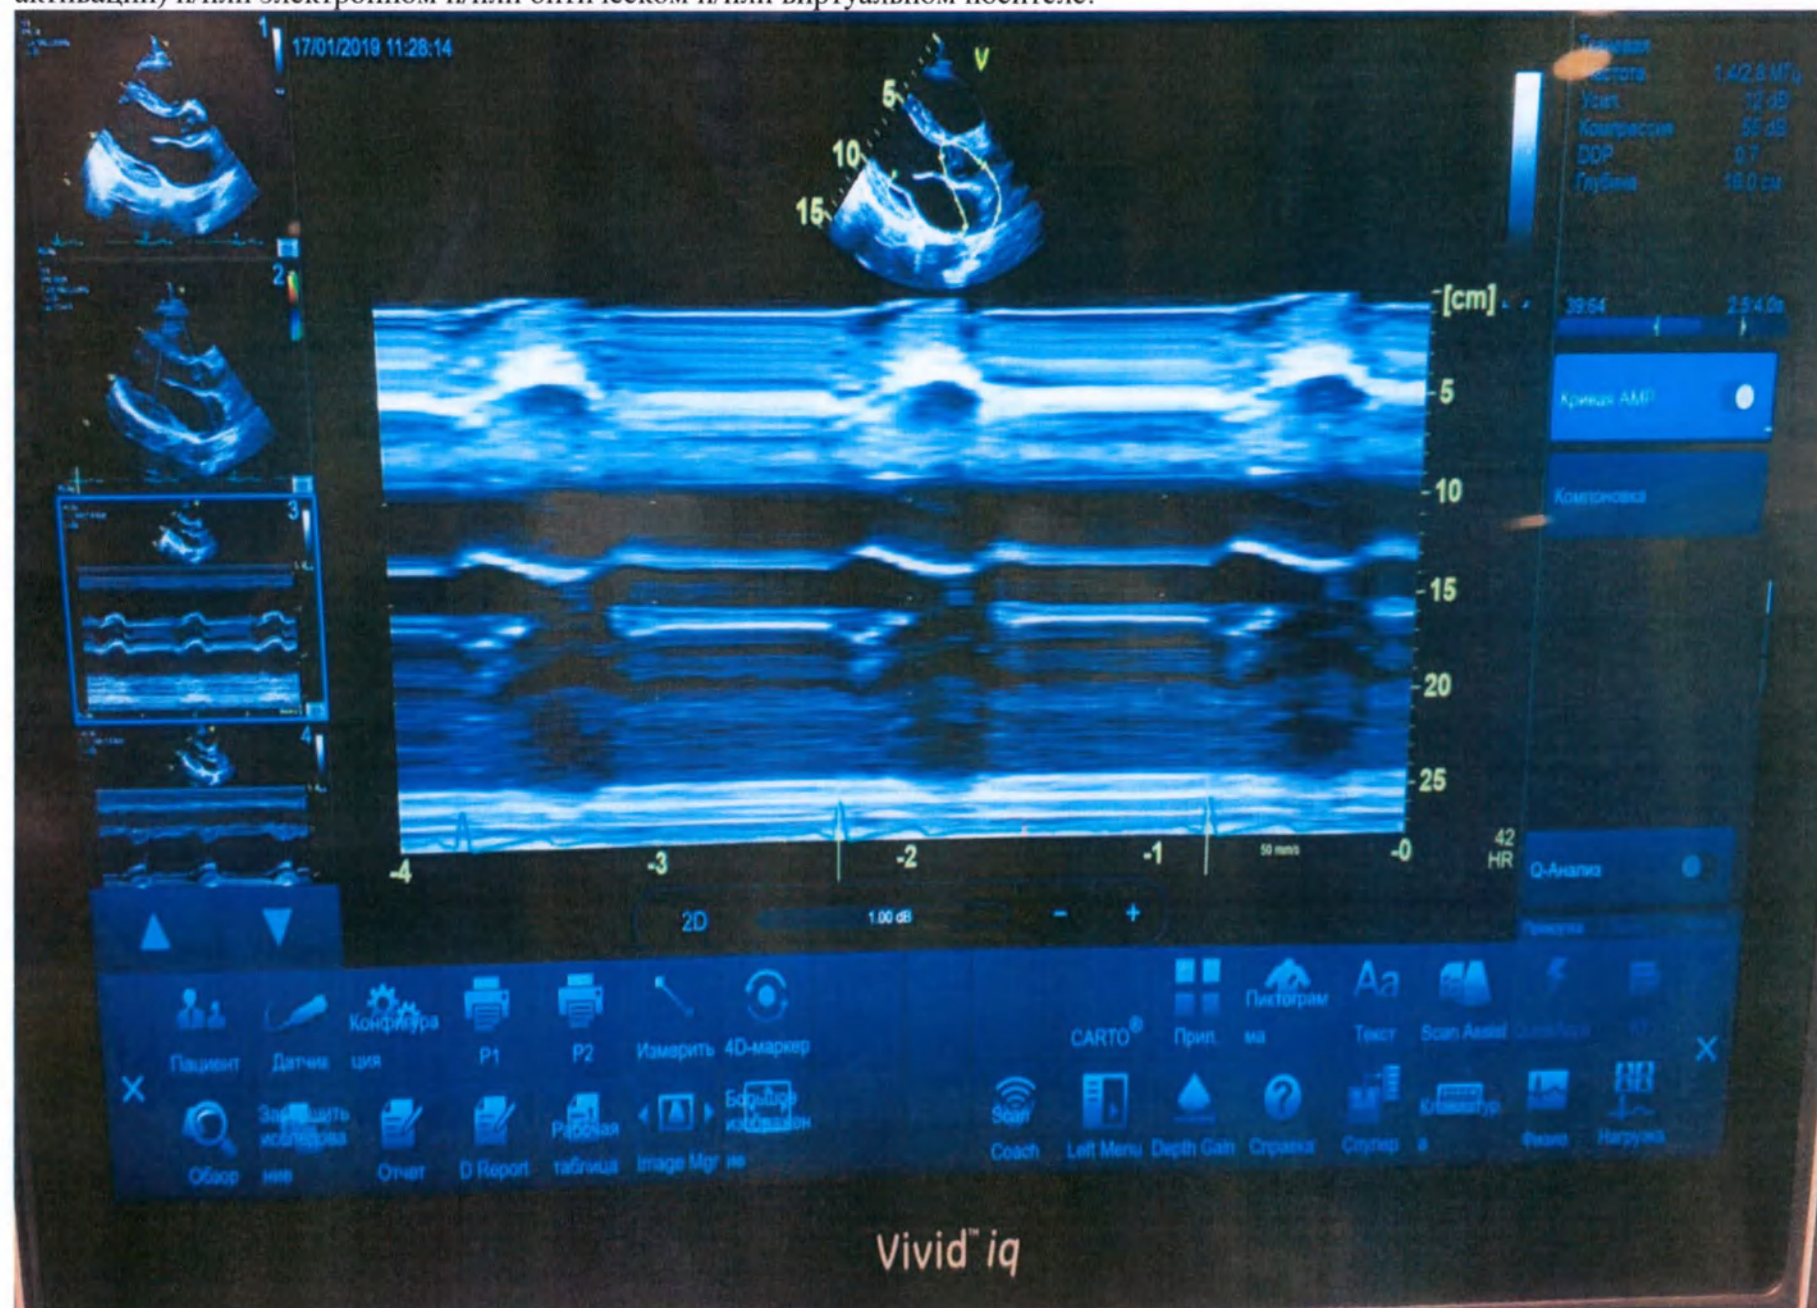


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, автоматической оценки глобальной сократительной функции сердца одним нажатием на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

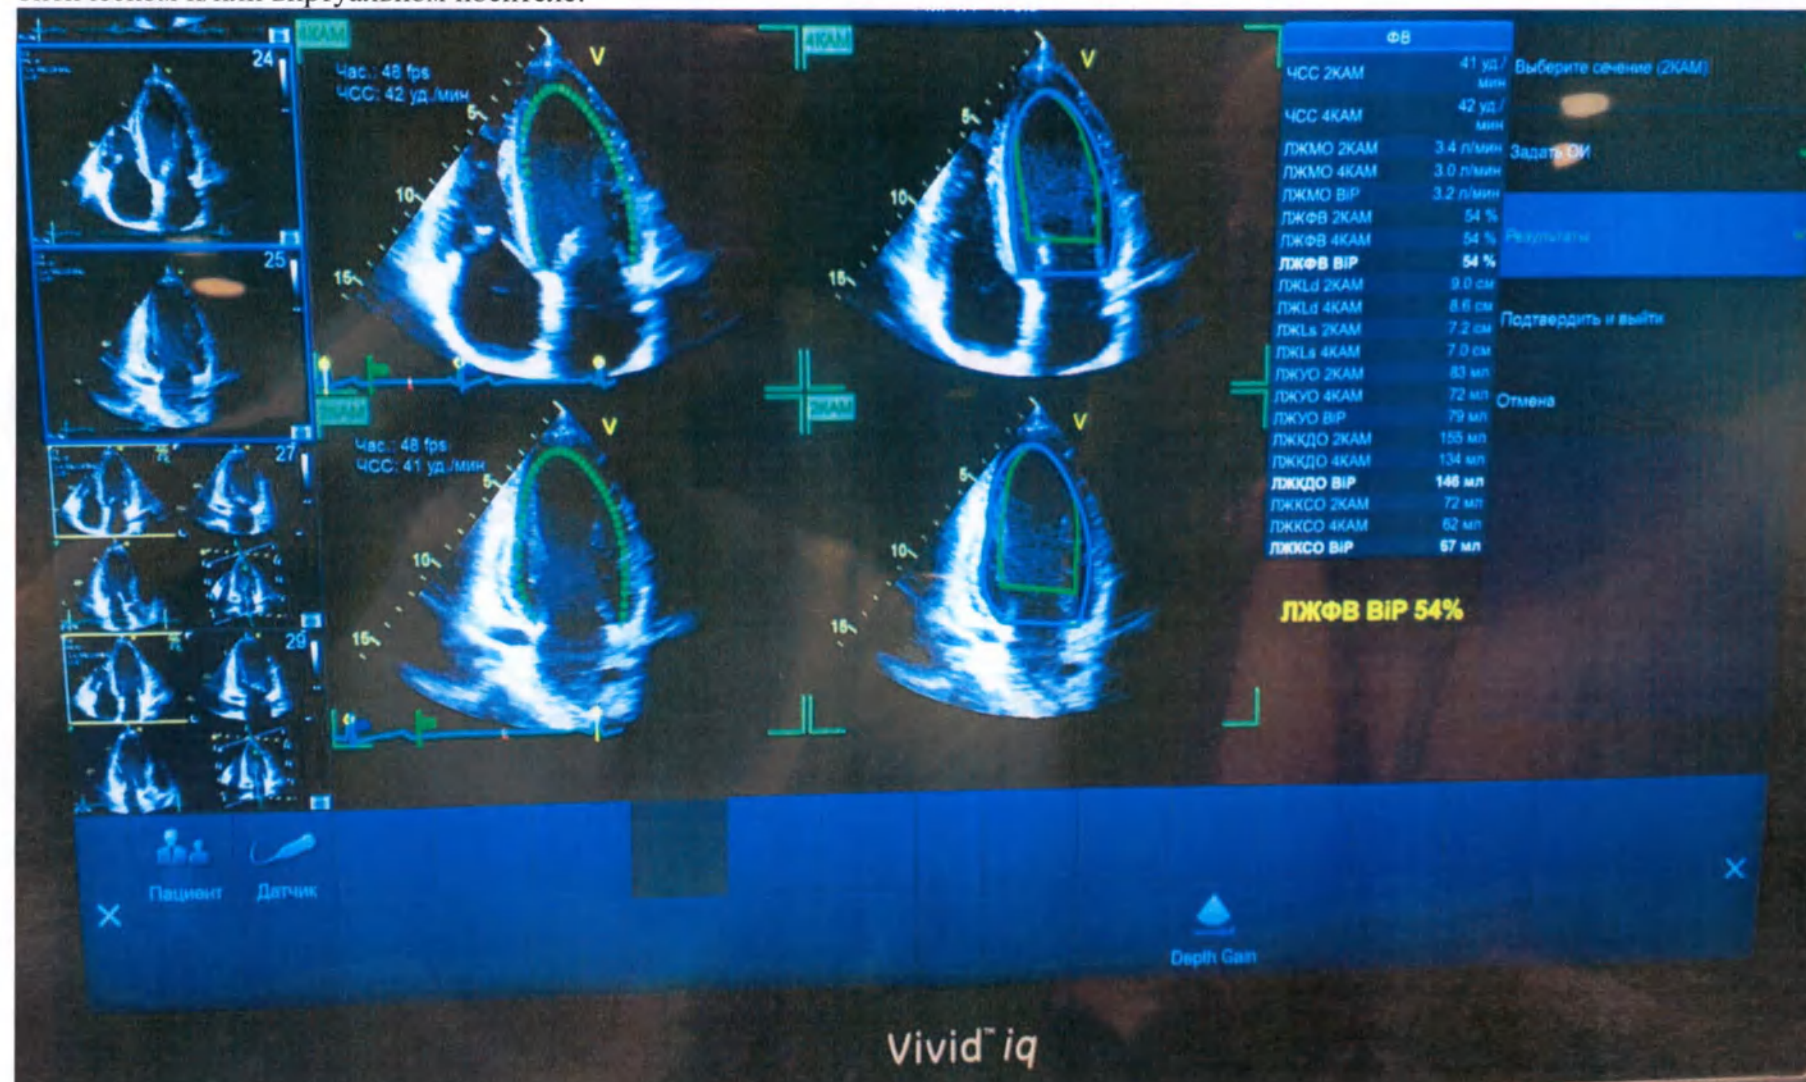


Электронный ключ для активации программного модуля сравнительного анализа ультразвуковых изображений на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

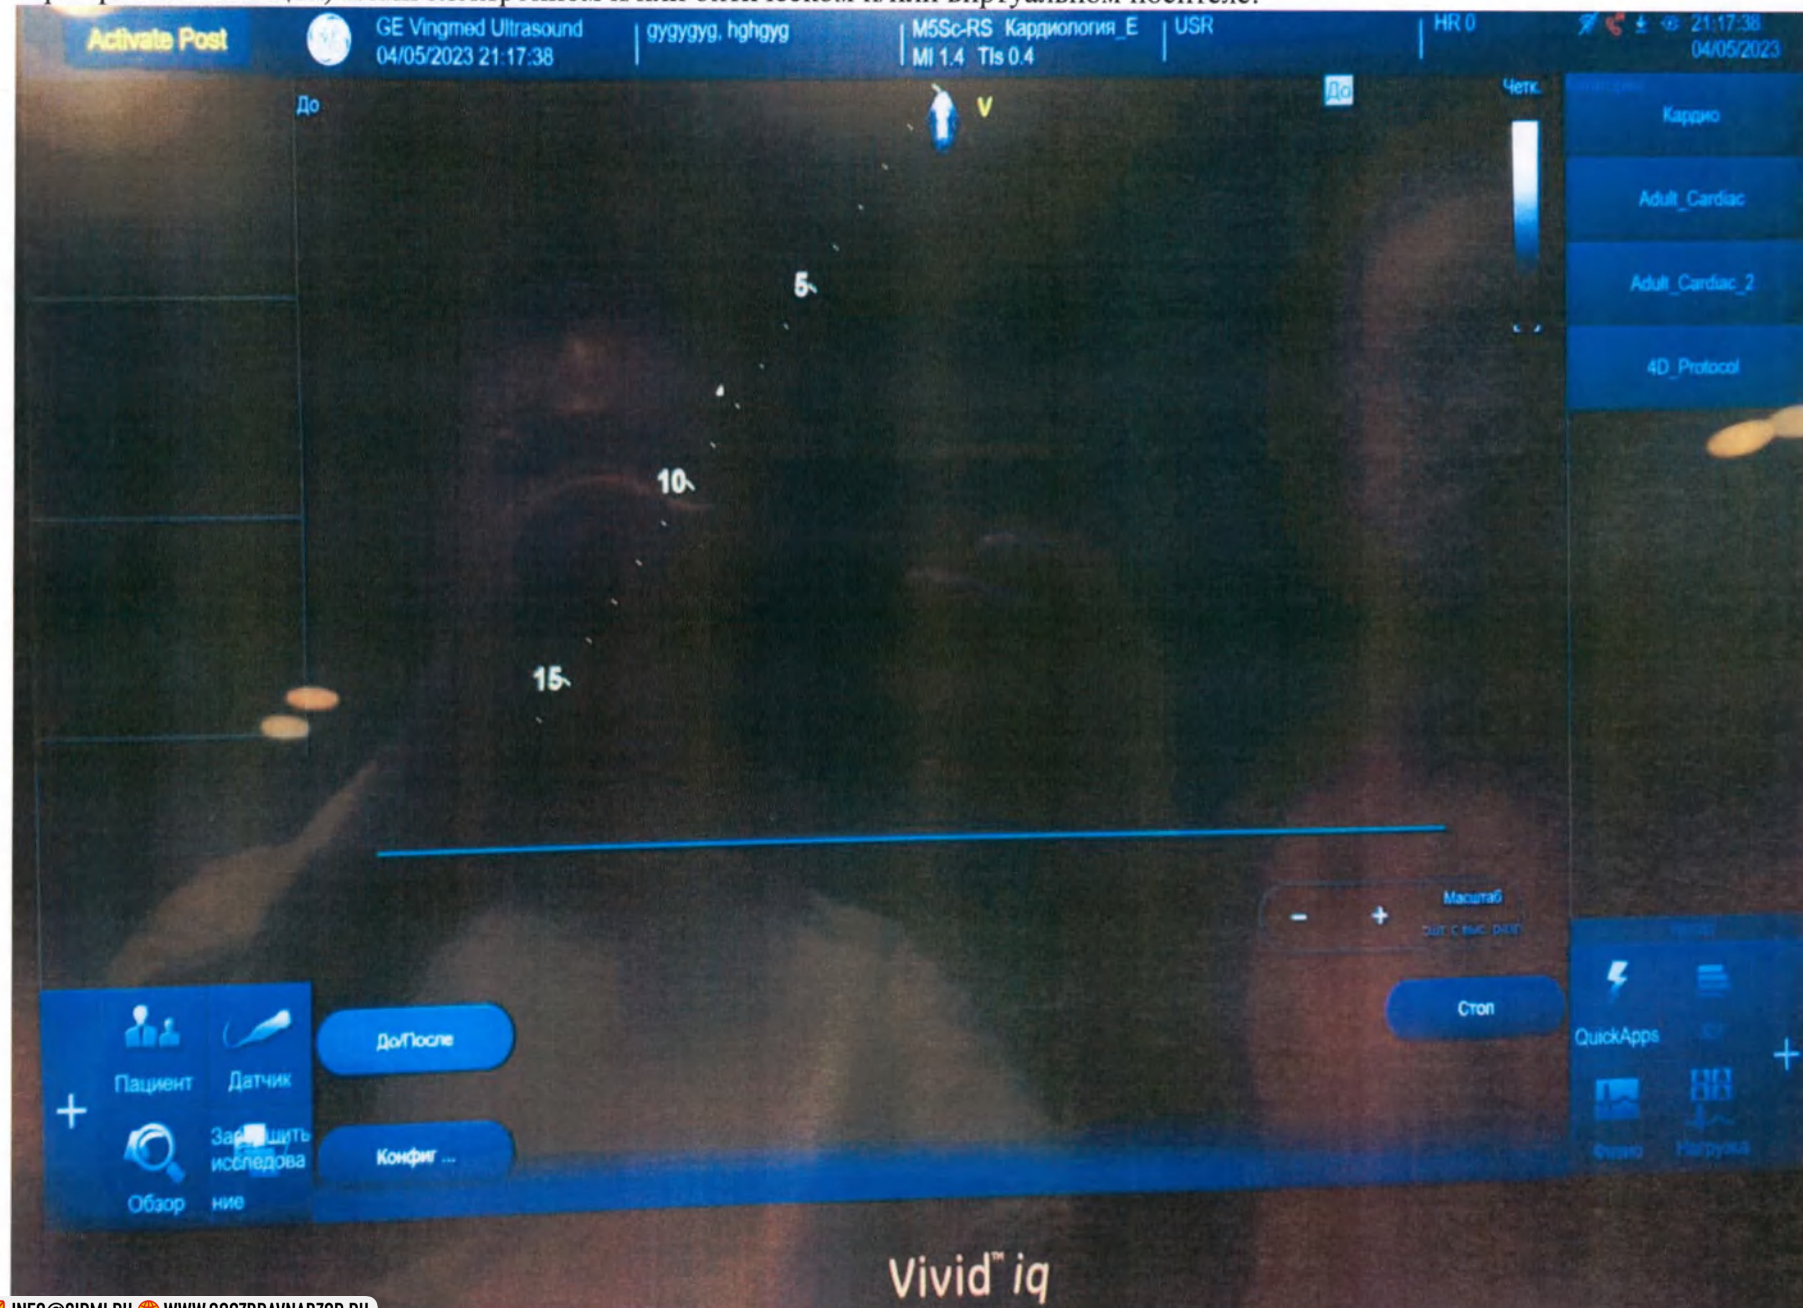


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения научно-практических исследований, неоплыверской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции сердца, степени деформации миокарда одним нажатием на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

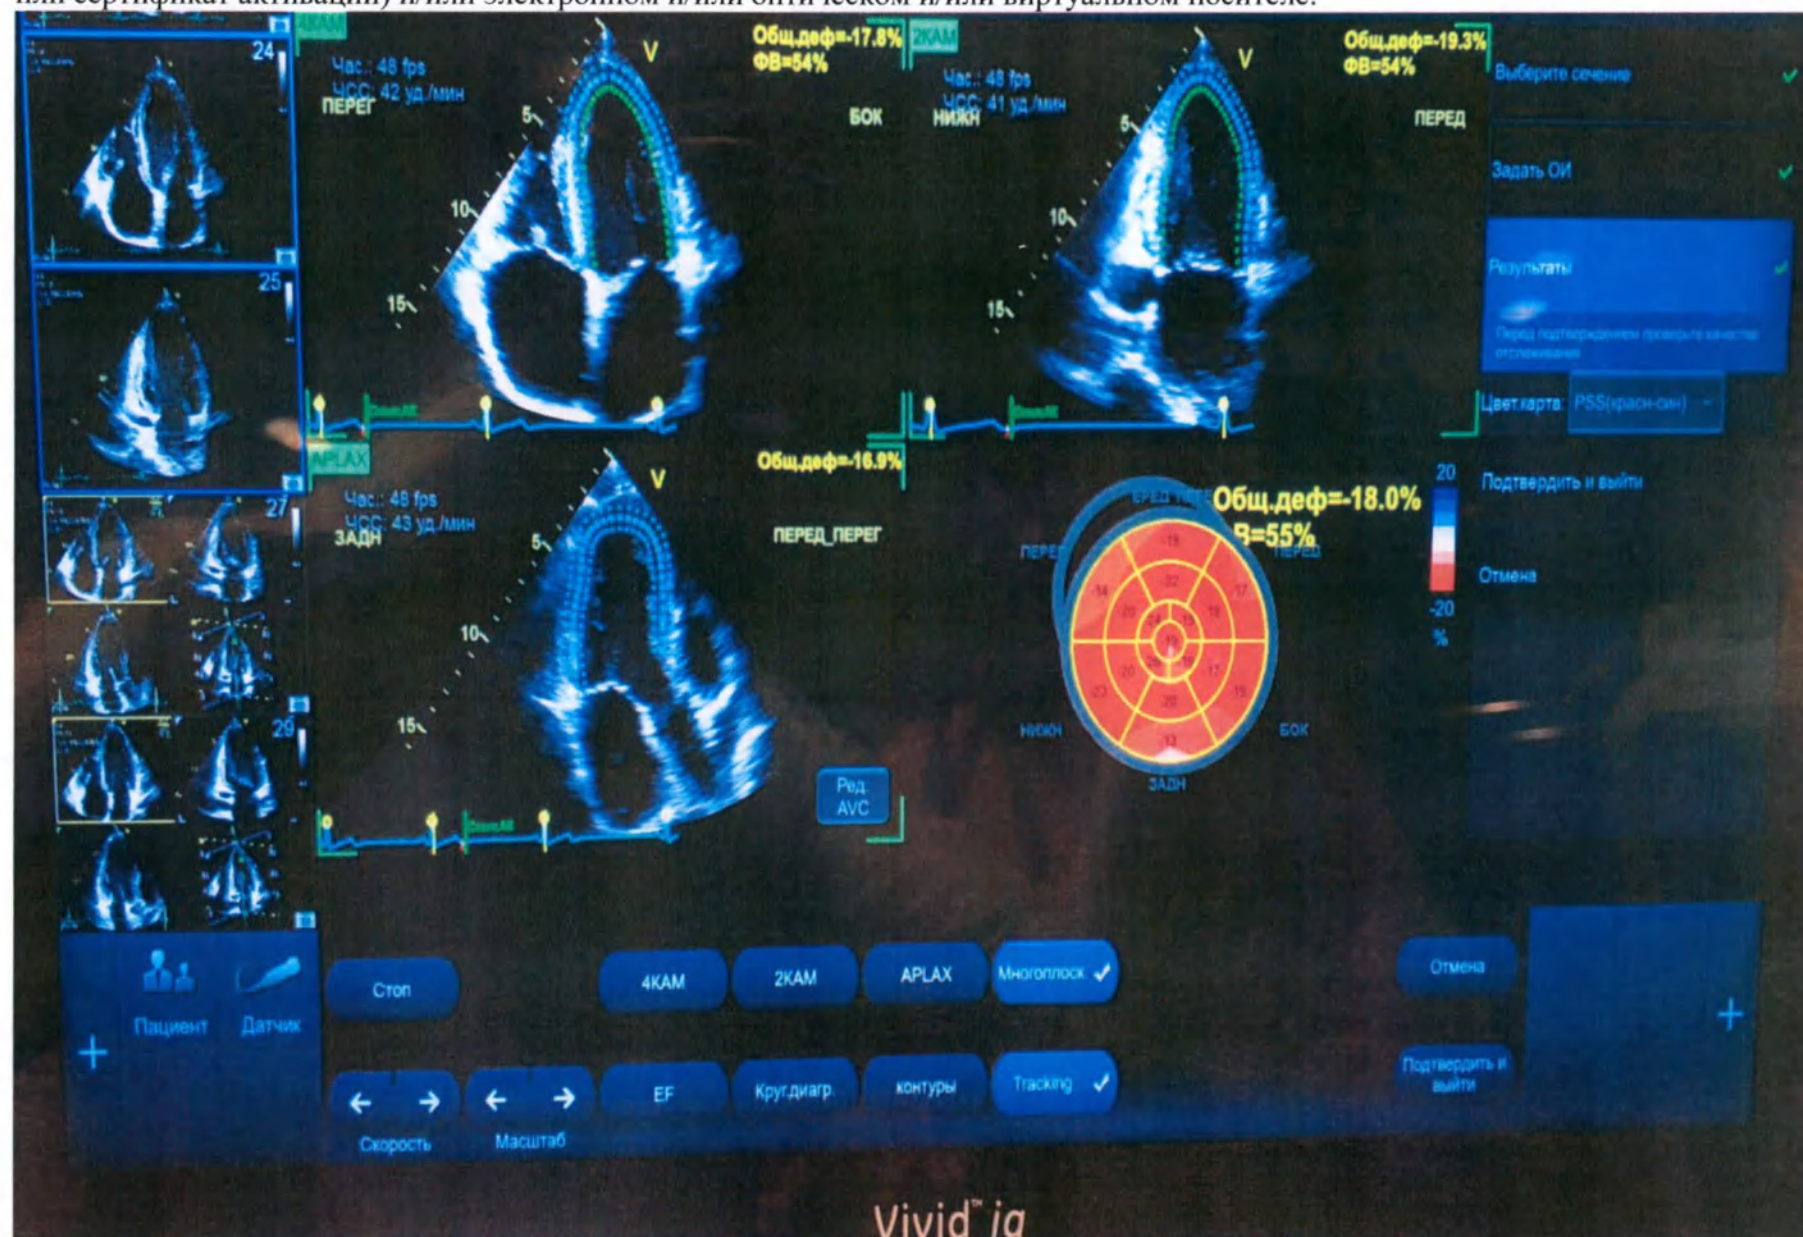


Электронный ключ для активации программного модуля для проведения контрастных исследований, в том числе с низким механическим индексом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

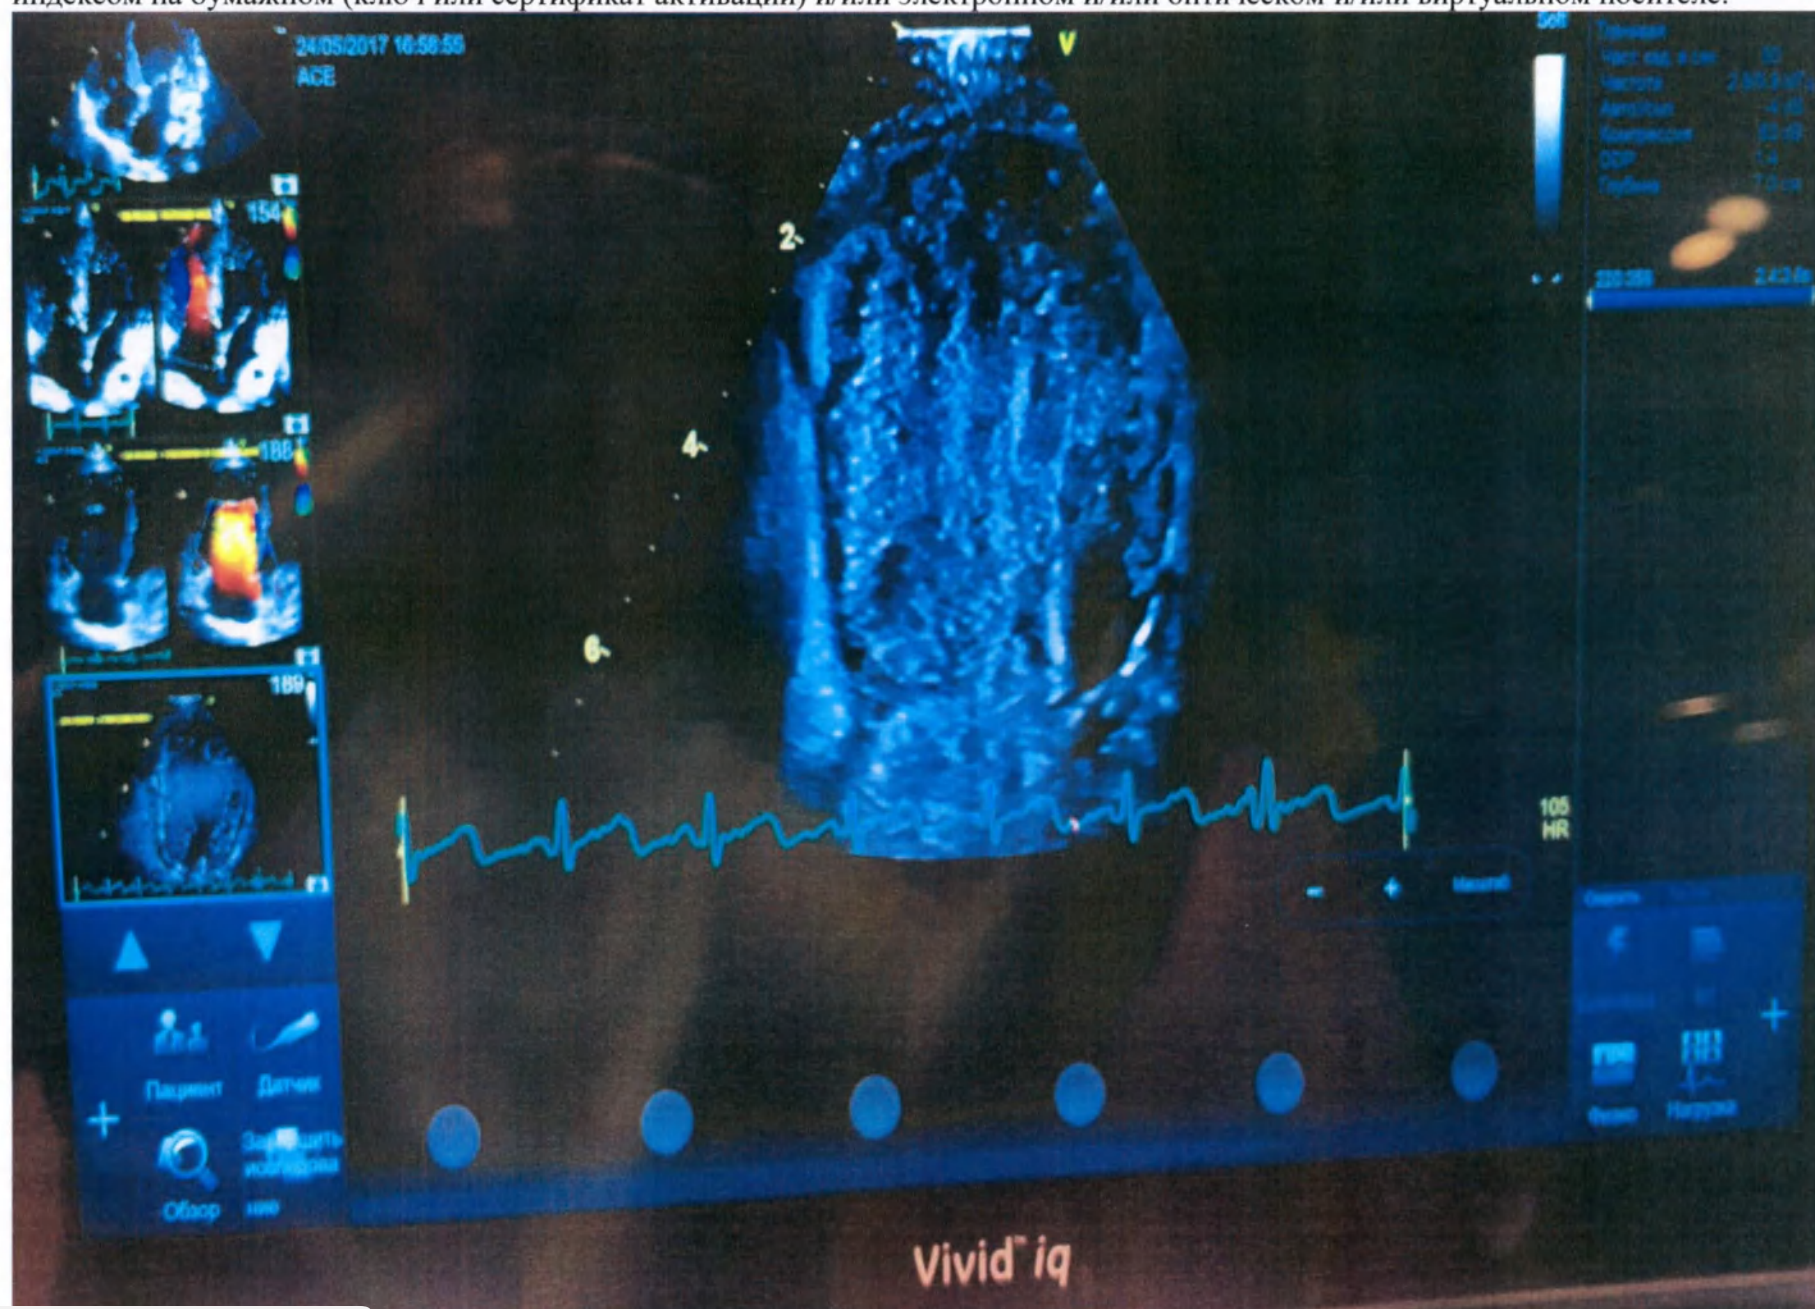

Электронный ключ для активации программного модуля для контрастных исследований сосудов и органов брюшной полости на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

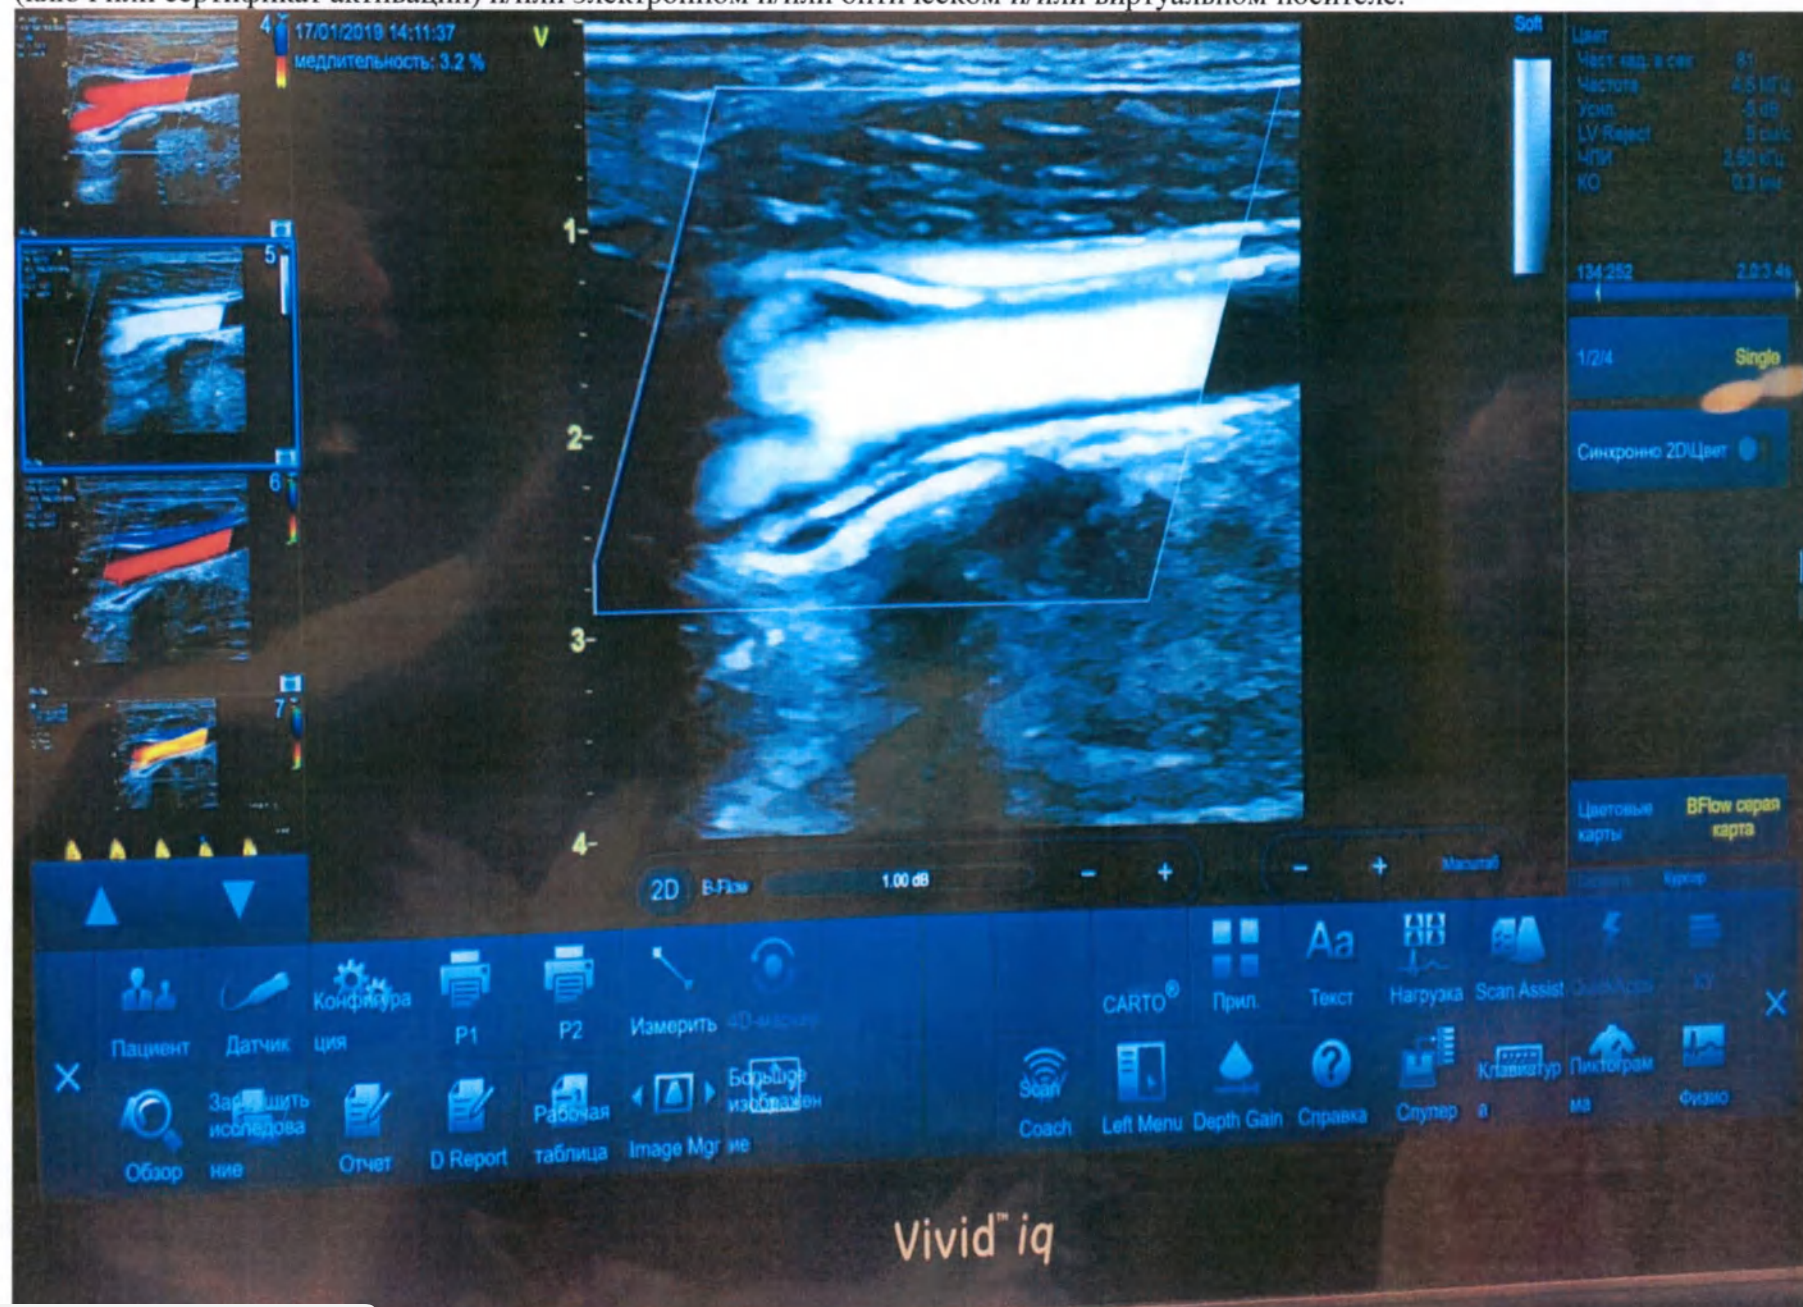

Тележка для перевозки и хранения прибора с кабелями соединительными.

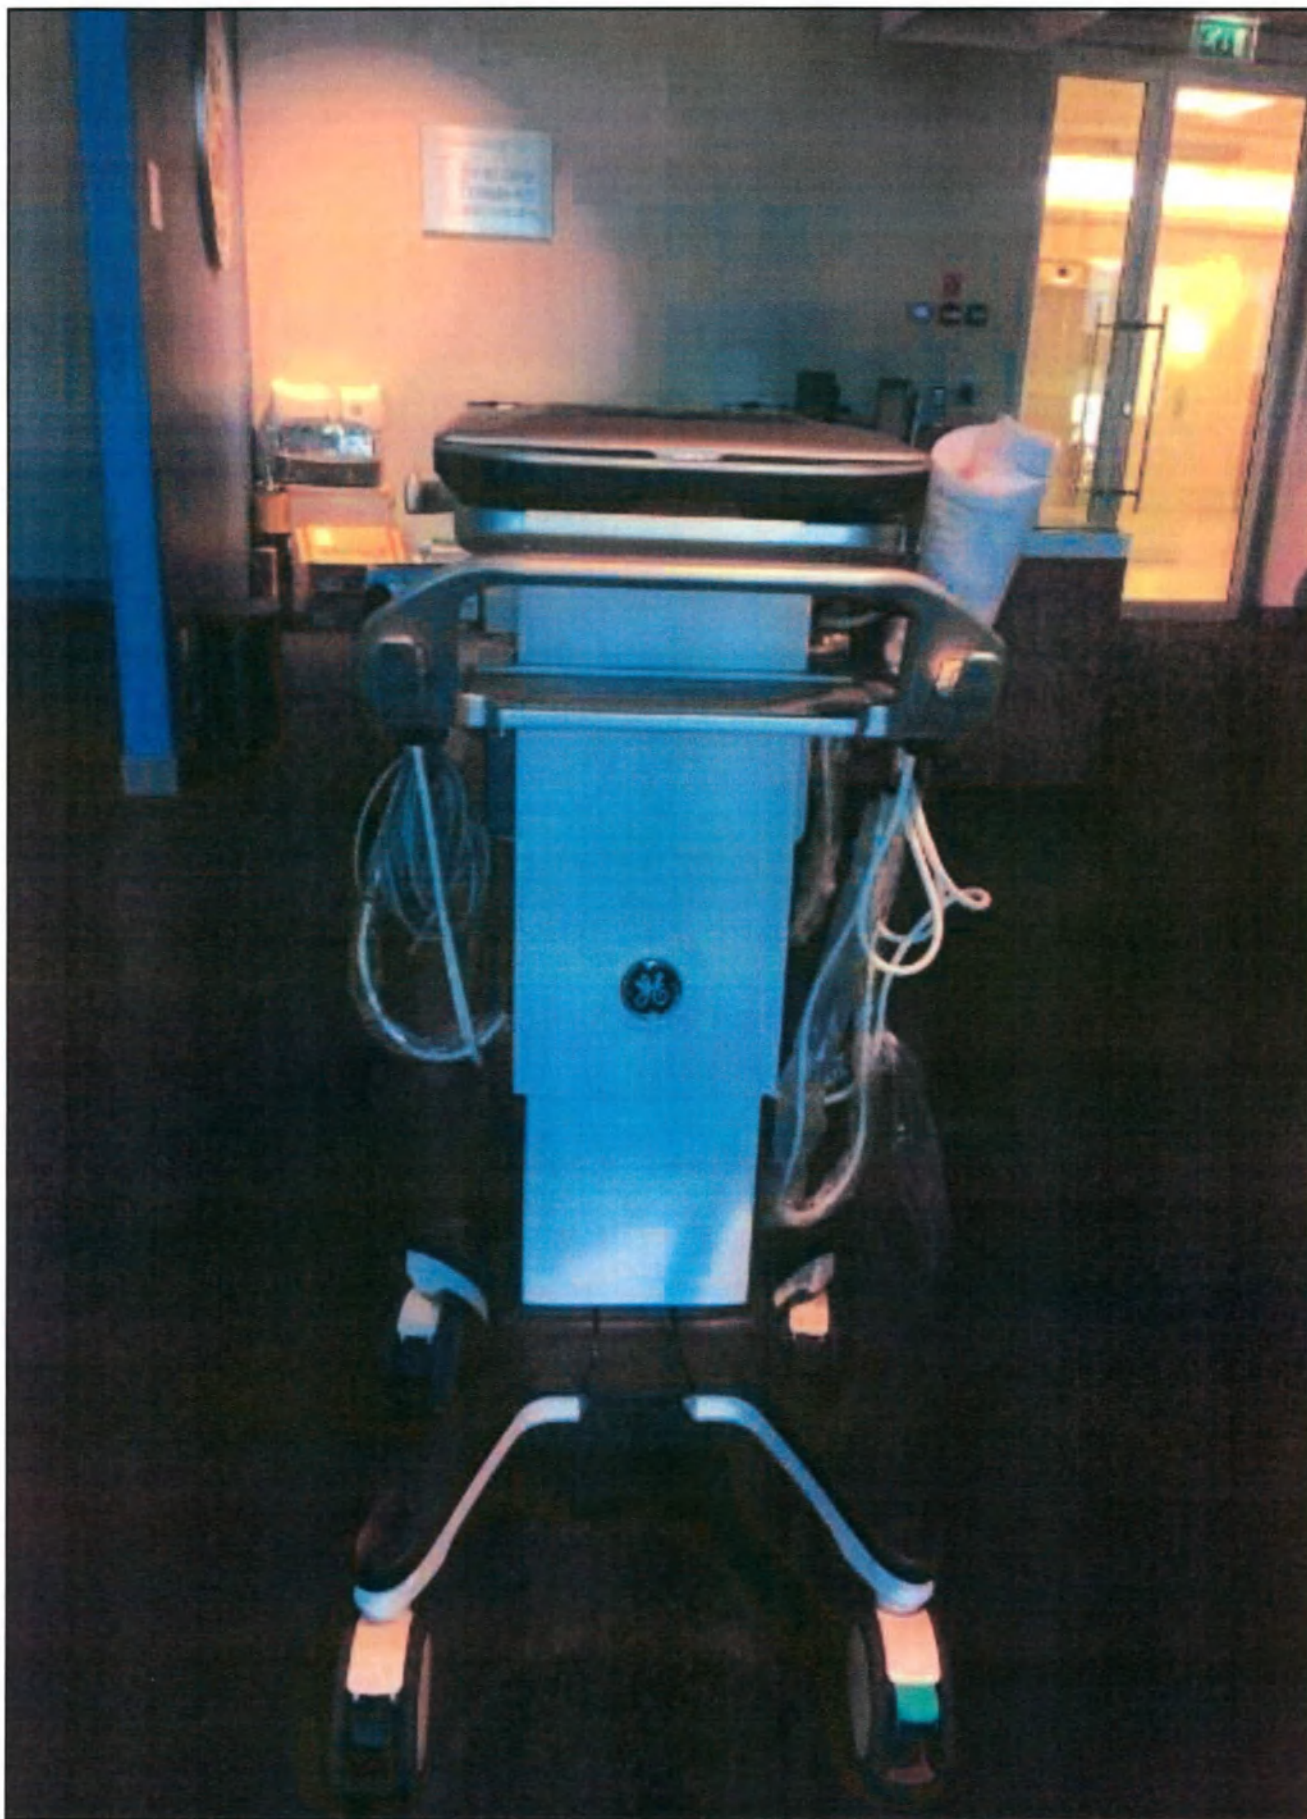

Макет маркировки Тележка для перевозки и хранения прибора с кабелями соединительными



GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO., LTD NO.19,CHANGJIANG ROAD, WUXI,
NATIONAL HI-TECH DEVELOPMENT ZONE JIANGSU P.R.CHINA 214028
通用电气医疗系统（中国）有限公司
中国江苏省无锡市国家高新技术产业开发区长江路19号 邮编：214028

DESC. 名称: MOBILE CART
MODEL 型号: SGCART

Only for use with Vivid iq
仅供 Vivid iq 系列使用


INPUT : 100 - 240V~, 50/60Hz, 300VA
OUTPUT : 22V $\approx$ 10.4A

ASSEMBLE IN CHINA



CISPR 11 / EN 55011
CLASS: A GROUP: 1
CLASSE: A GROUPE: 1

Модуль аппаратный расширитель для подключения 4-х датчиков для тележки.

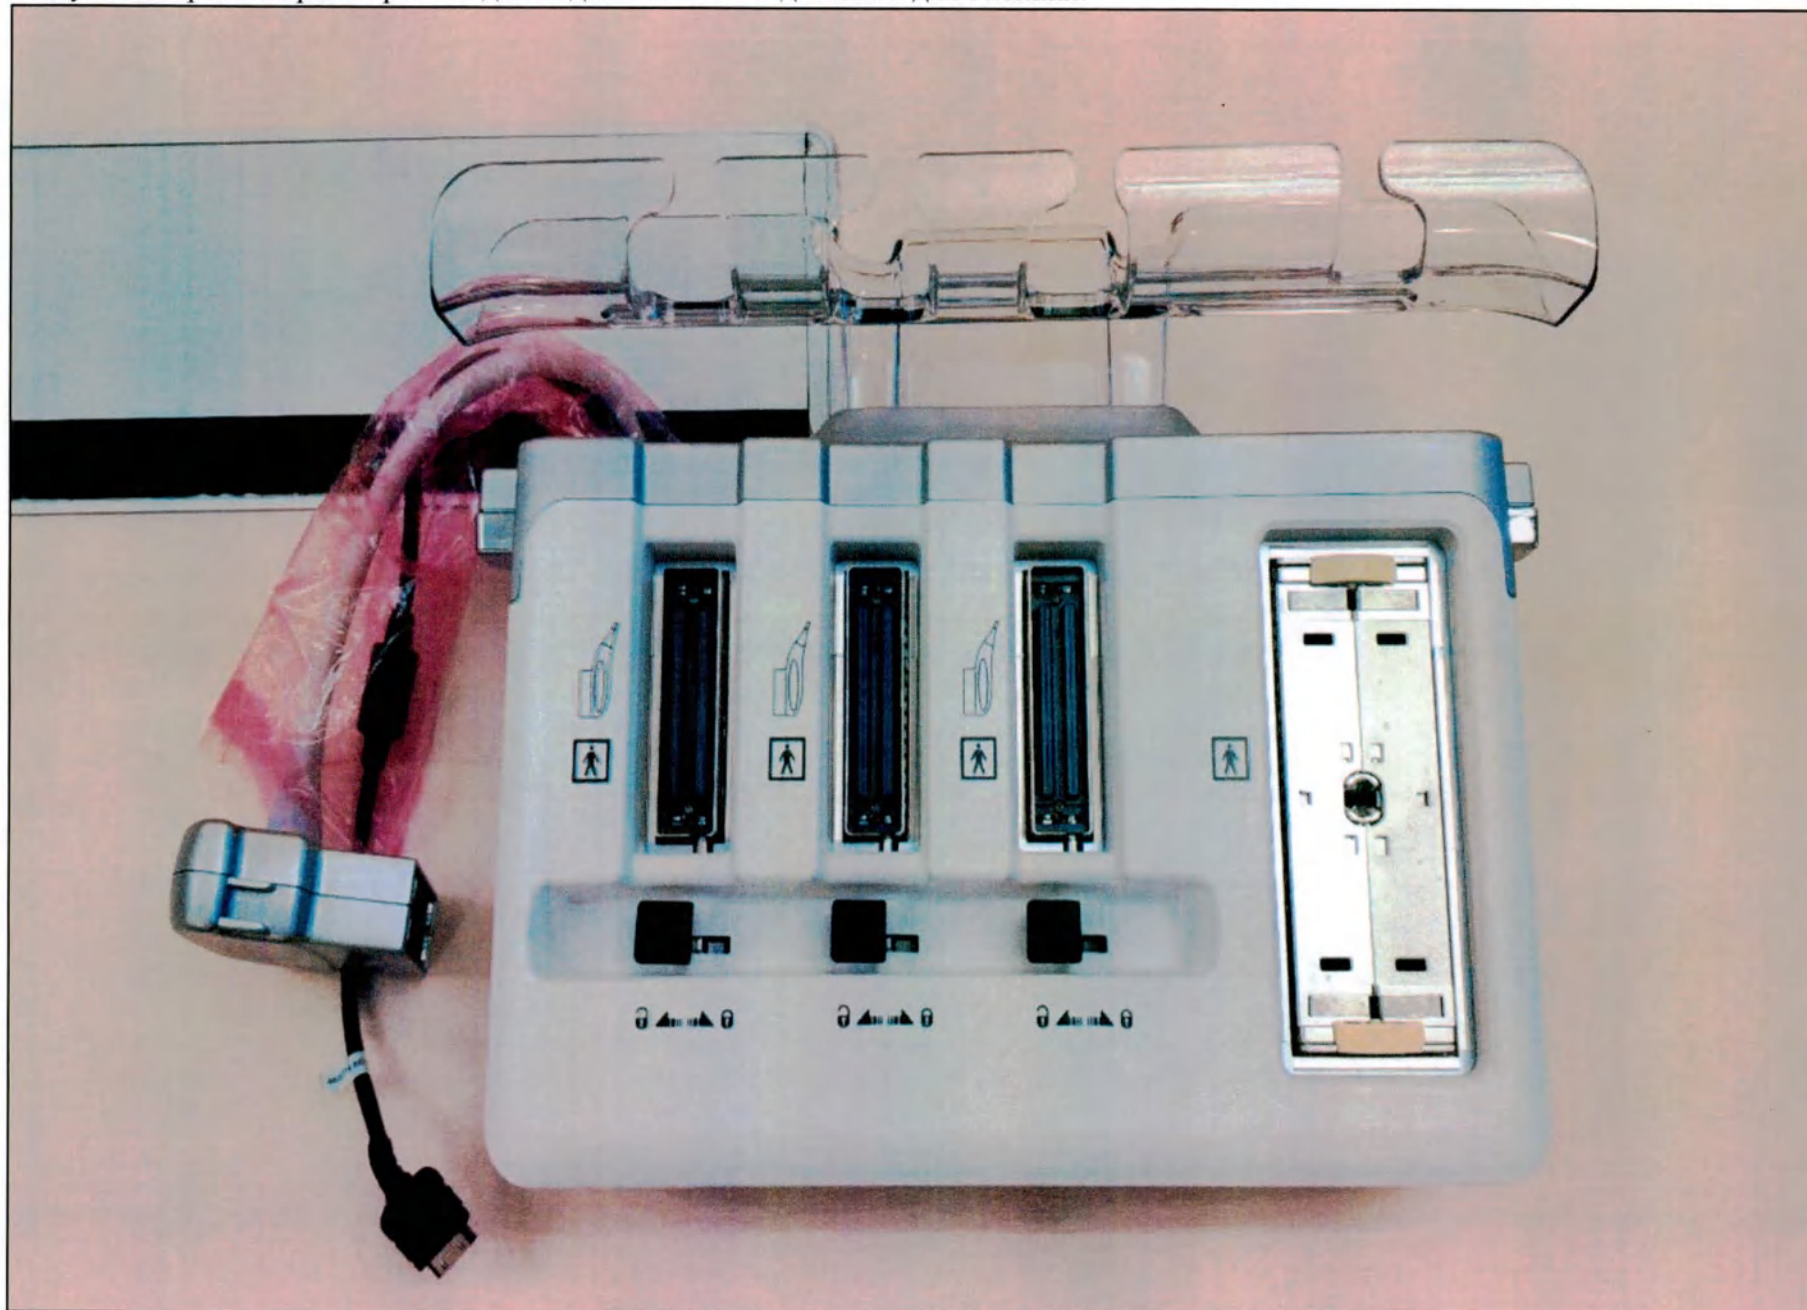

Макет маркировки Модуль аппаратный расширитель для подключения 4-х датчиков для тележки

1 

2 Model:


3 SN

4 P/N

5 

6 


Полки для установки дополнительного оборудования: - Полка для установки дополнительного оборудования, передняя;
- Полка для установки дополнительного оборудования, задняя верхняя; - Полка для установки дополнительного оборудования, задняя нижняя.

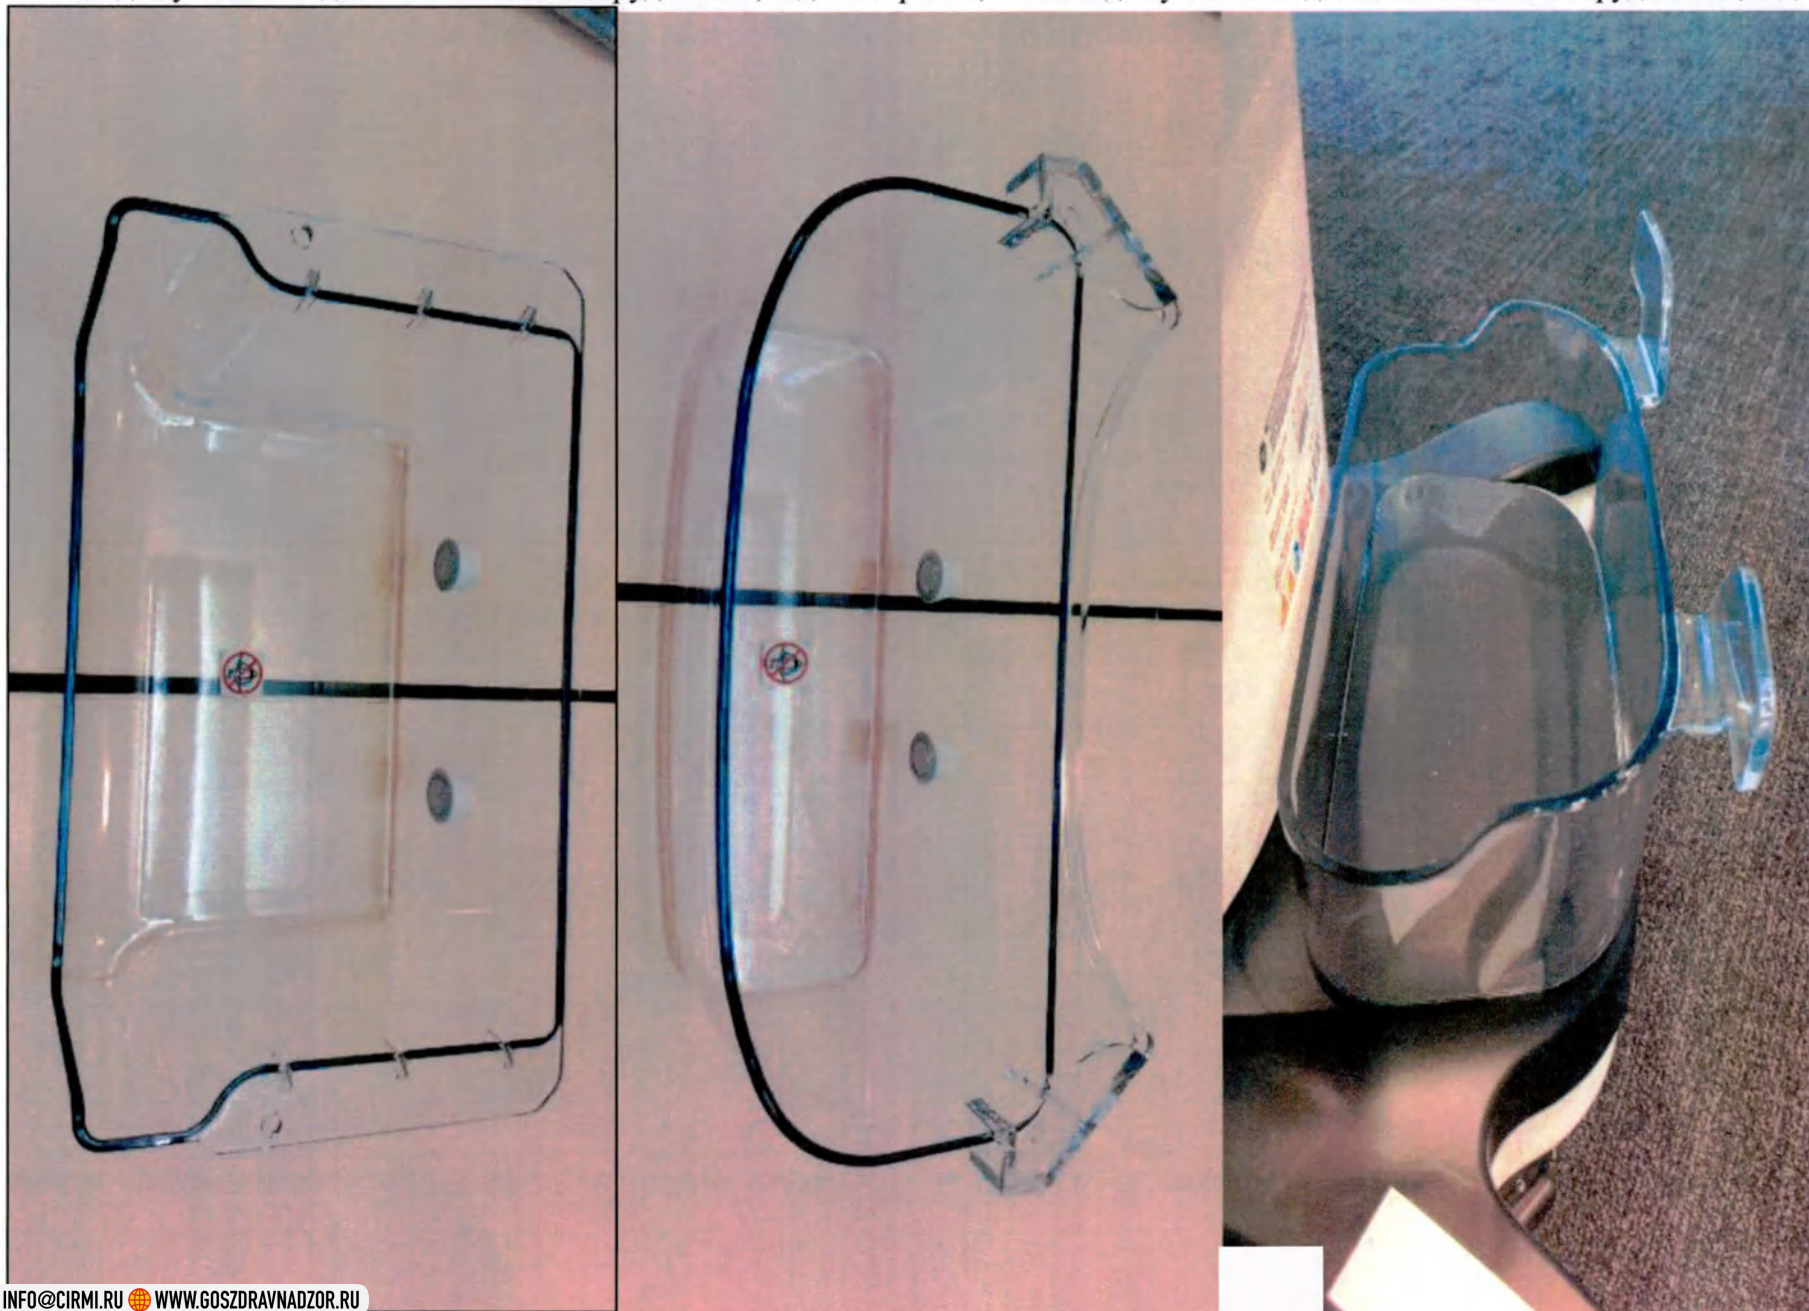

Чемодан для переноски и хранения системы.



Сумка для переноски аппарата.

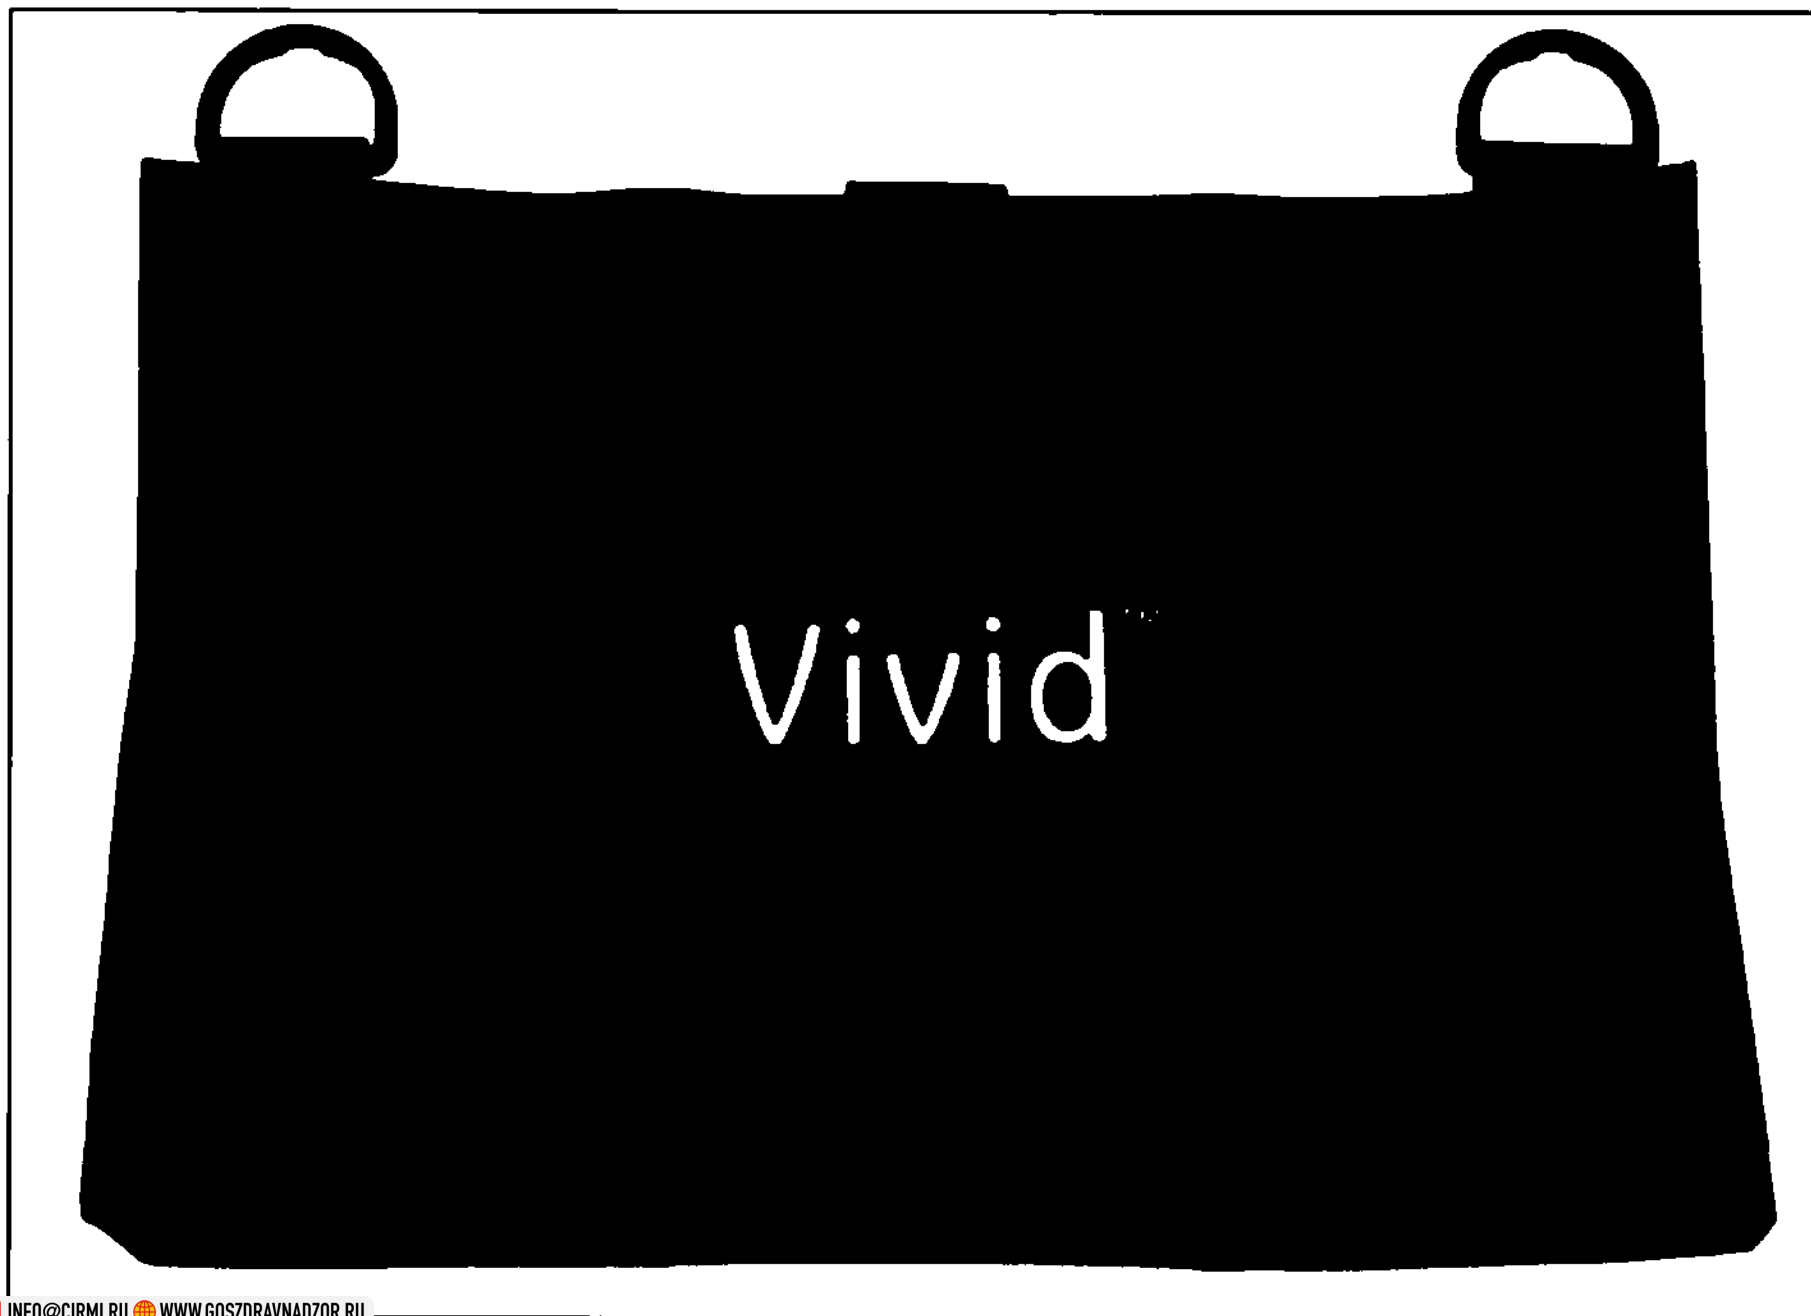

Дополнительный аккумулятор.



Макет маркировки Дополнительного аккумулятора.

 **GE Medical Systems**
(China) Co., Ltd.

No.19, Changjiang Road,
Wuxi National Hi-Tech Development Zone,
Jiangsu, P.R.China, 214028

Rechargeable Li-ion Smart Battery Pack 可充电电池
Model 型号: VSBP90
18.0V $\equiv$ 5.4Ah 97.2Wh 51NR19/66-2

警告:
禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
请勿置于高温环境中。

Caution: Risk of fire and burns.
Do not open, crush, or heat above 60 °C. **R-41058580**
Attention: Risque d'incendie et de brûlures.
Ne pas ouvrir, écraser, ou chauffer au dessus de 60 °C.

Factory 生产厂: ICC ELECTRONICS(DONGGUAN)LTD.
NO.23, Shang Yuan Road, Qingxi Town,
Dongguan City, Guangdong, P.R. China

 **Li-ion**

 **IS 16046/**
IEC62133




REF 5717315 REV.2
SN WWWW-00001
YYYY-MM




Made in China
产地中国


Дополнительные держатели для датчиков.

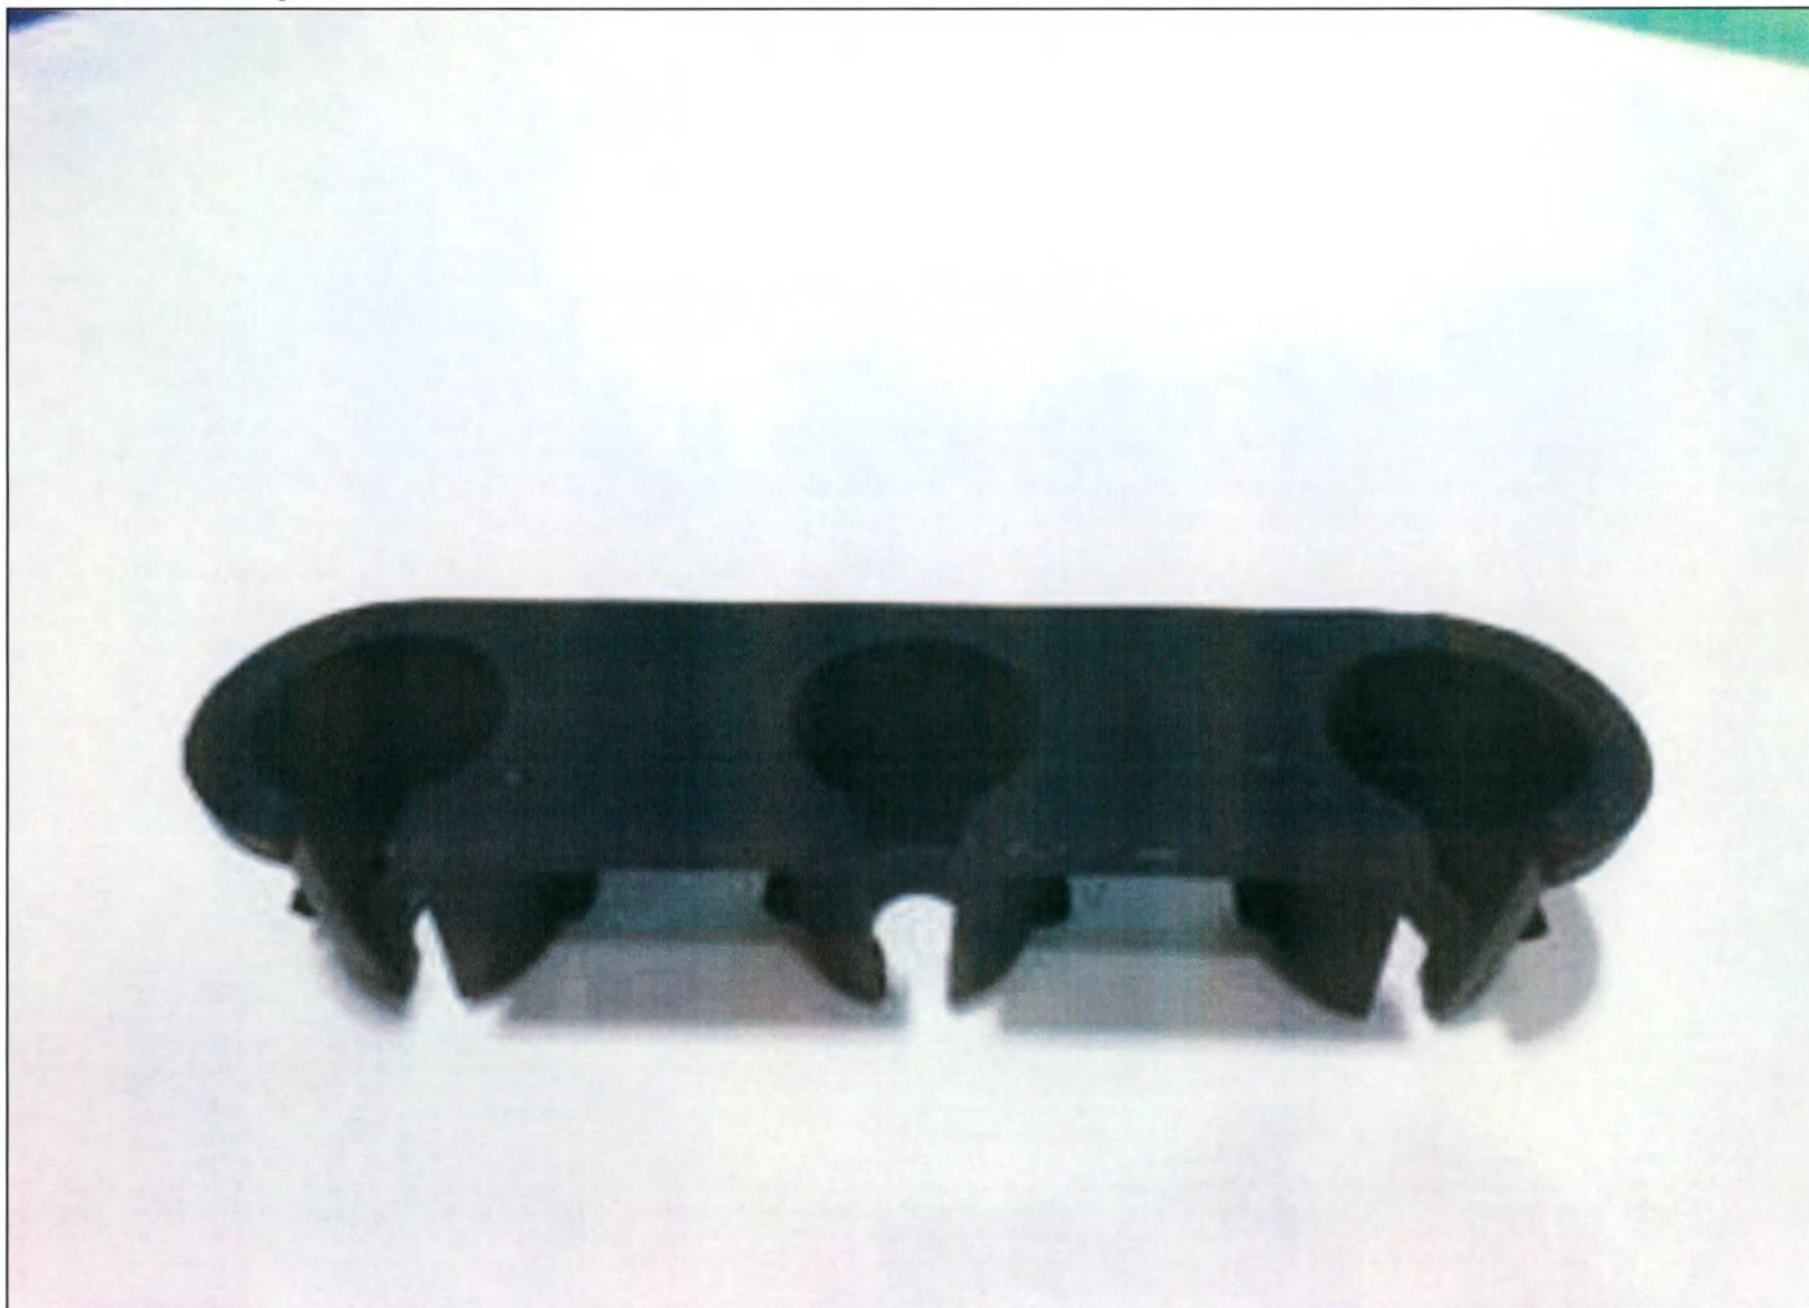


Педаль управления.

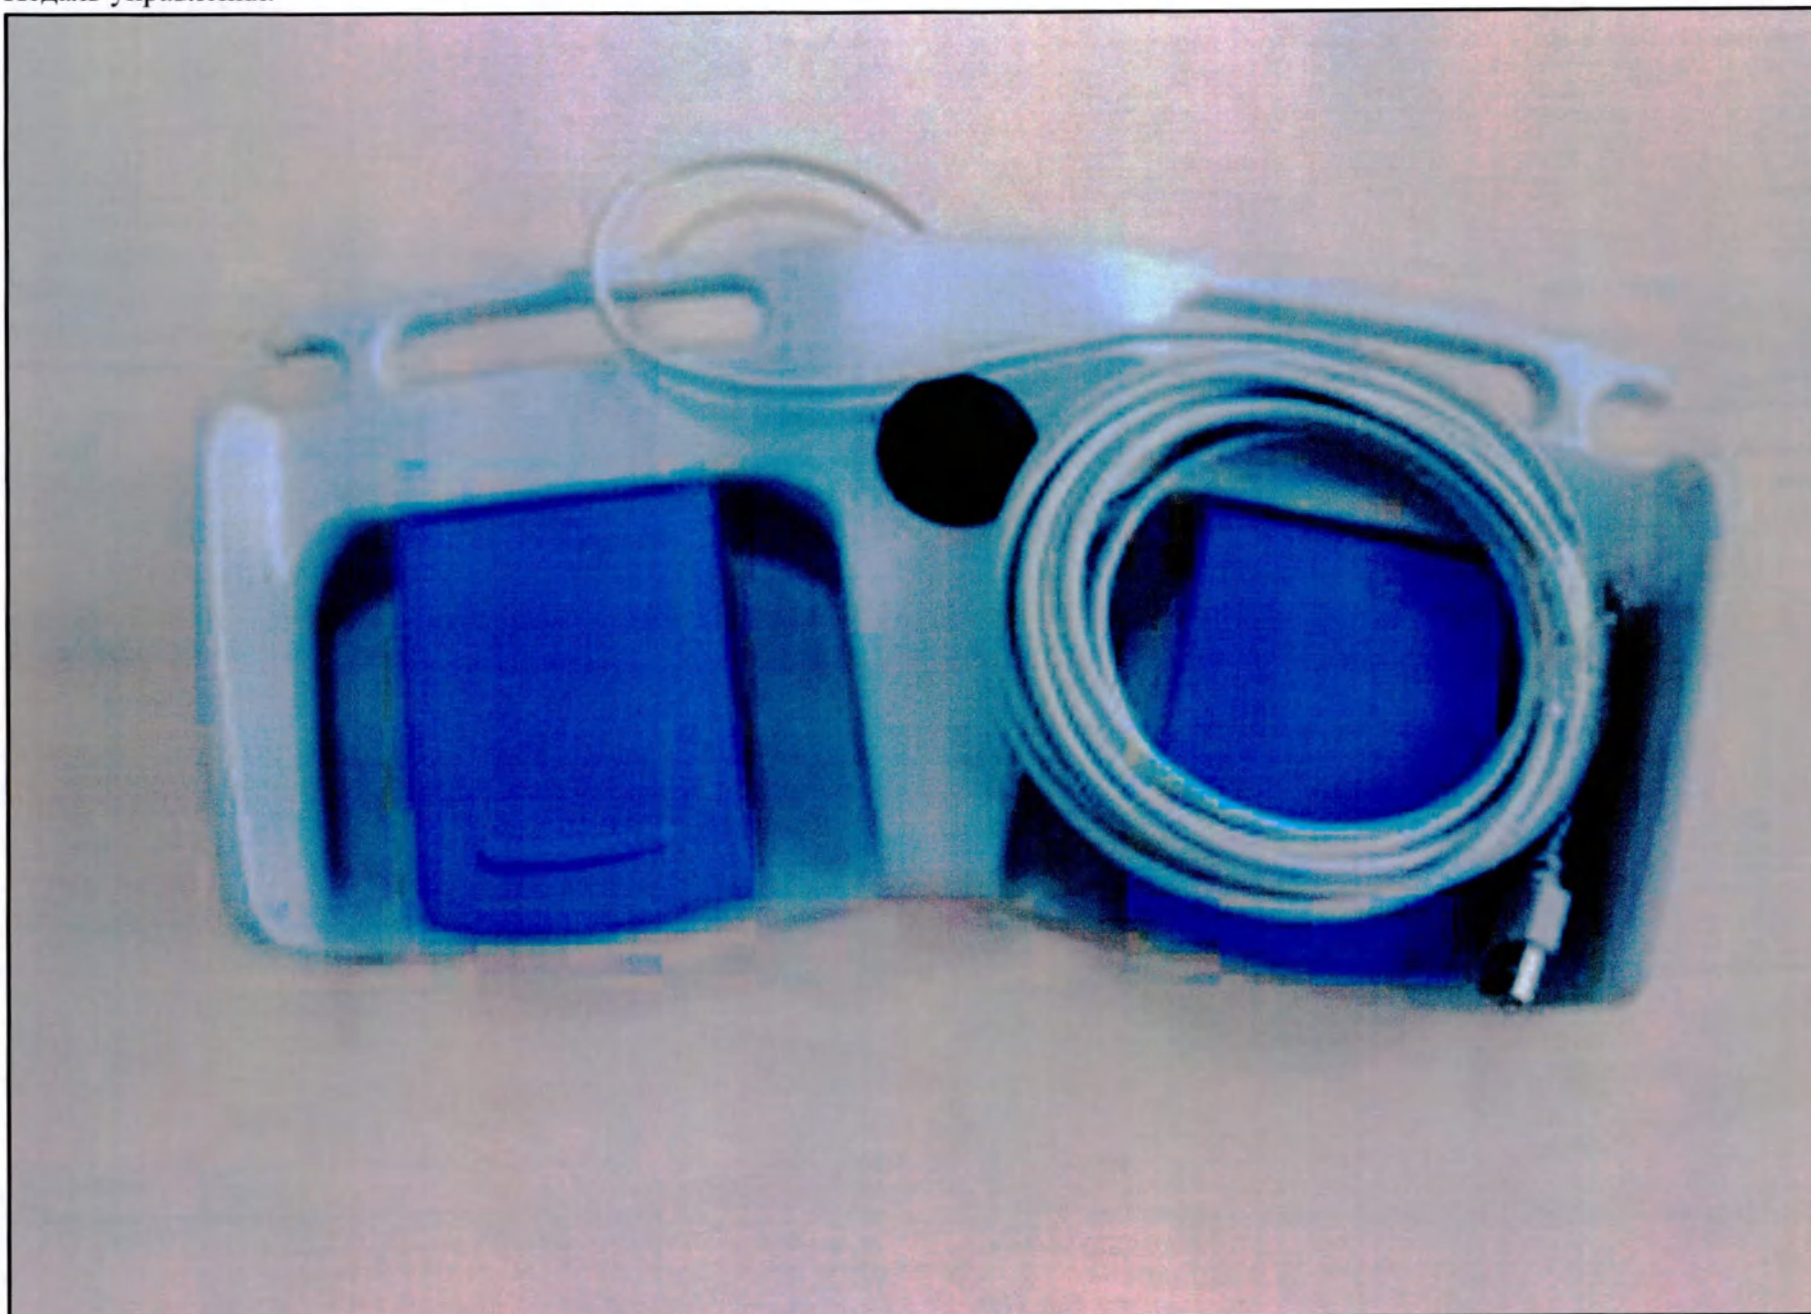


Макет маркировки Педаль управления.

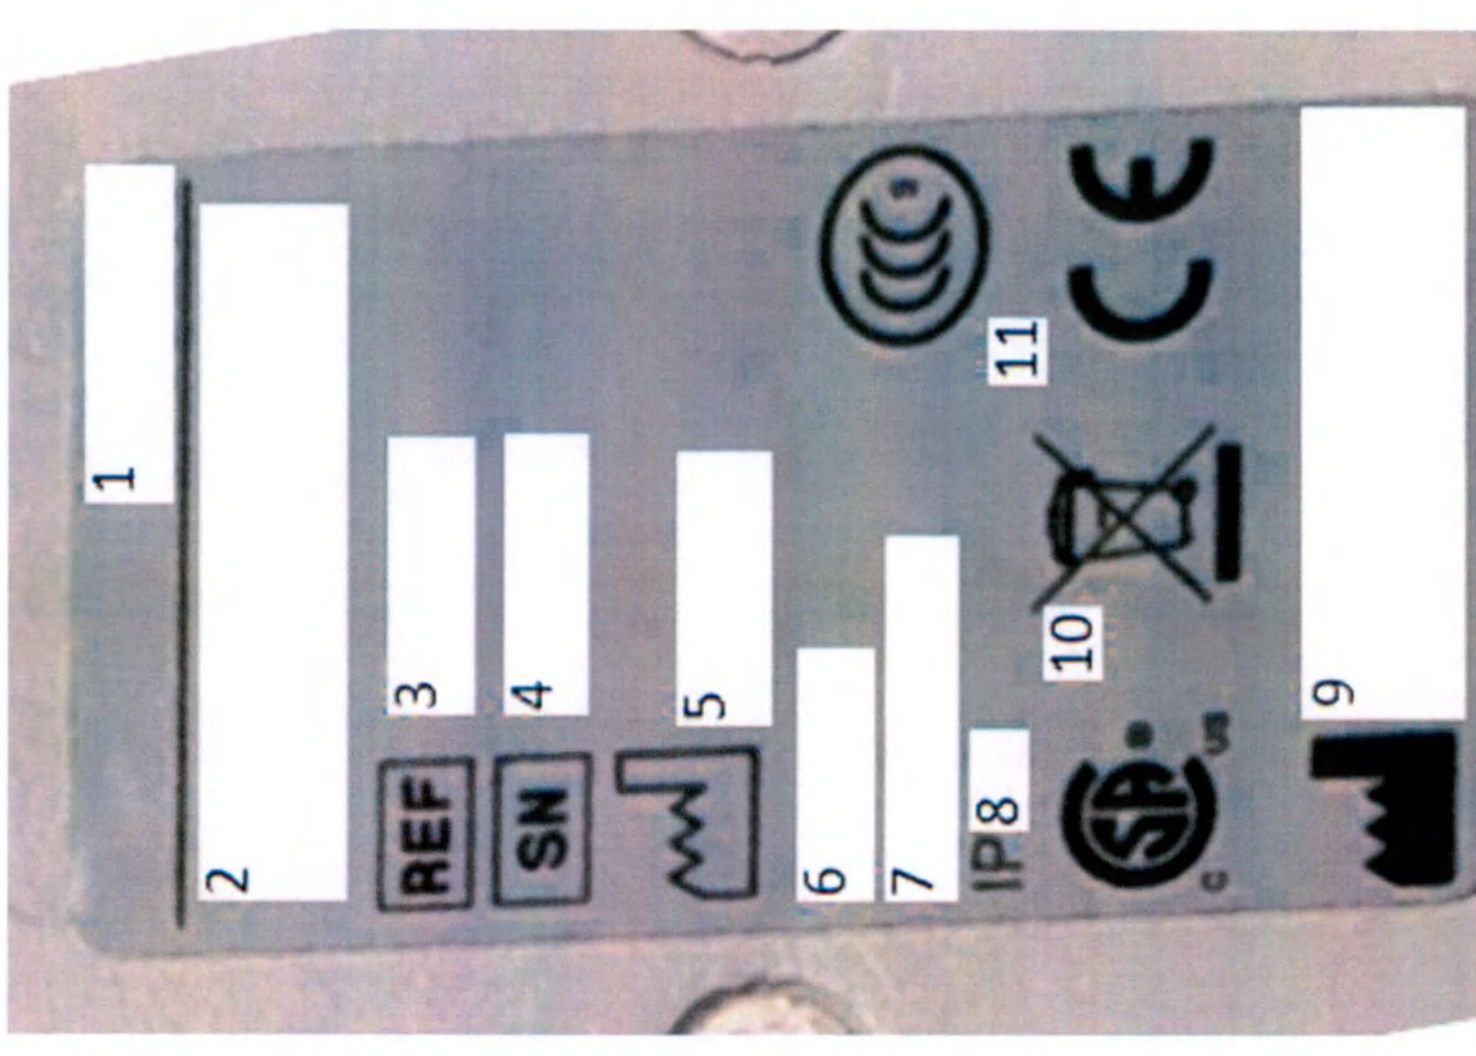

Защитная пленка для панели оператора.

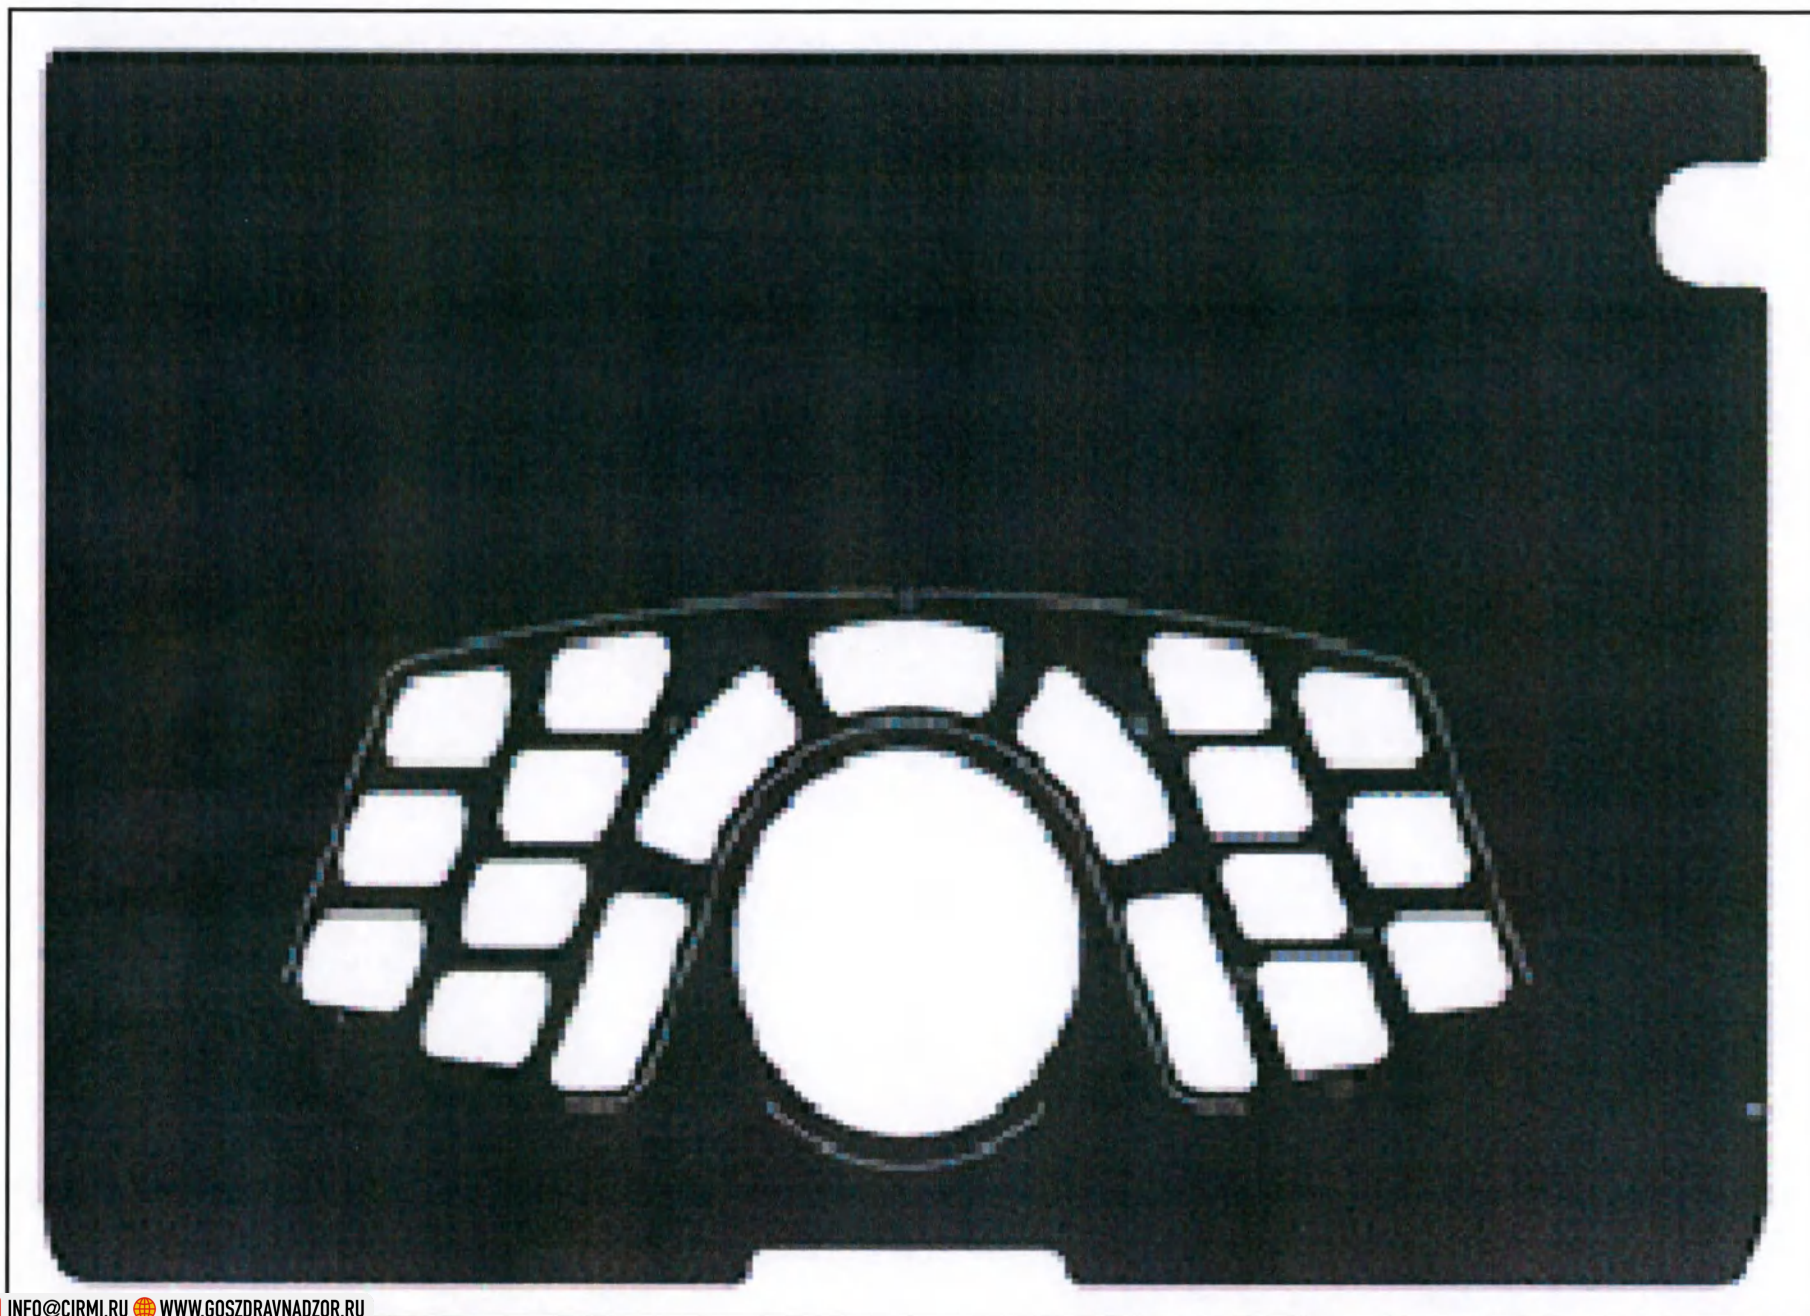


Внешний CD/DVD привод.

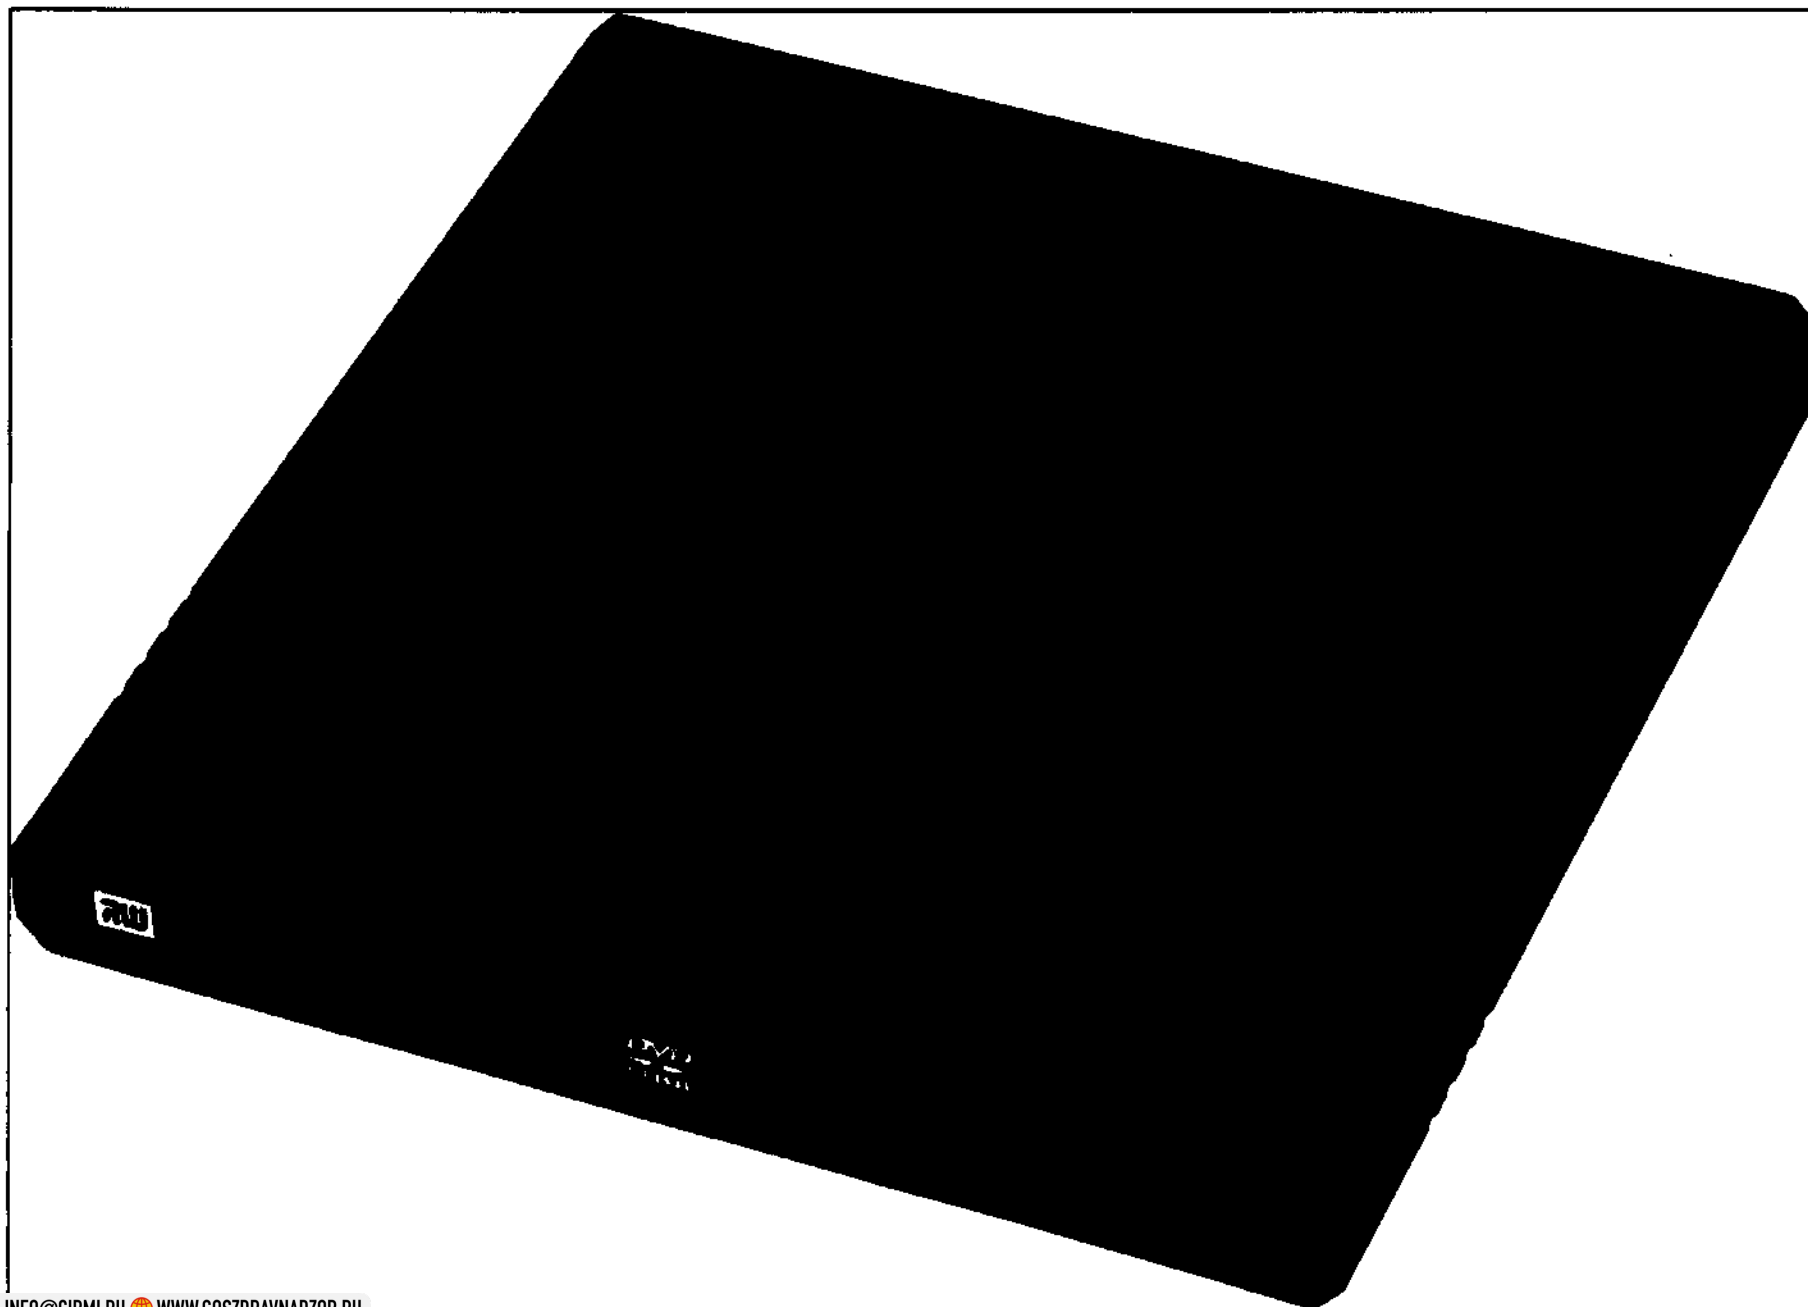

Внешний жесткий USB диск для хранения цифровой информации.




Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения и текст в комплекте с кабелями для подключения или без них.

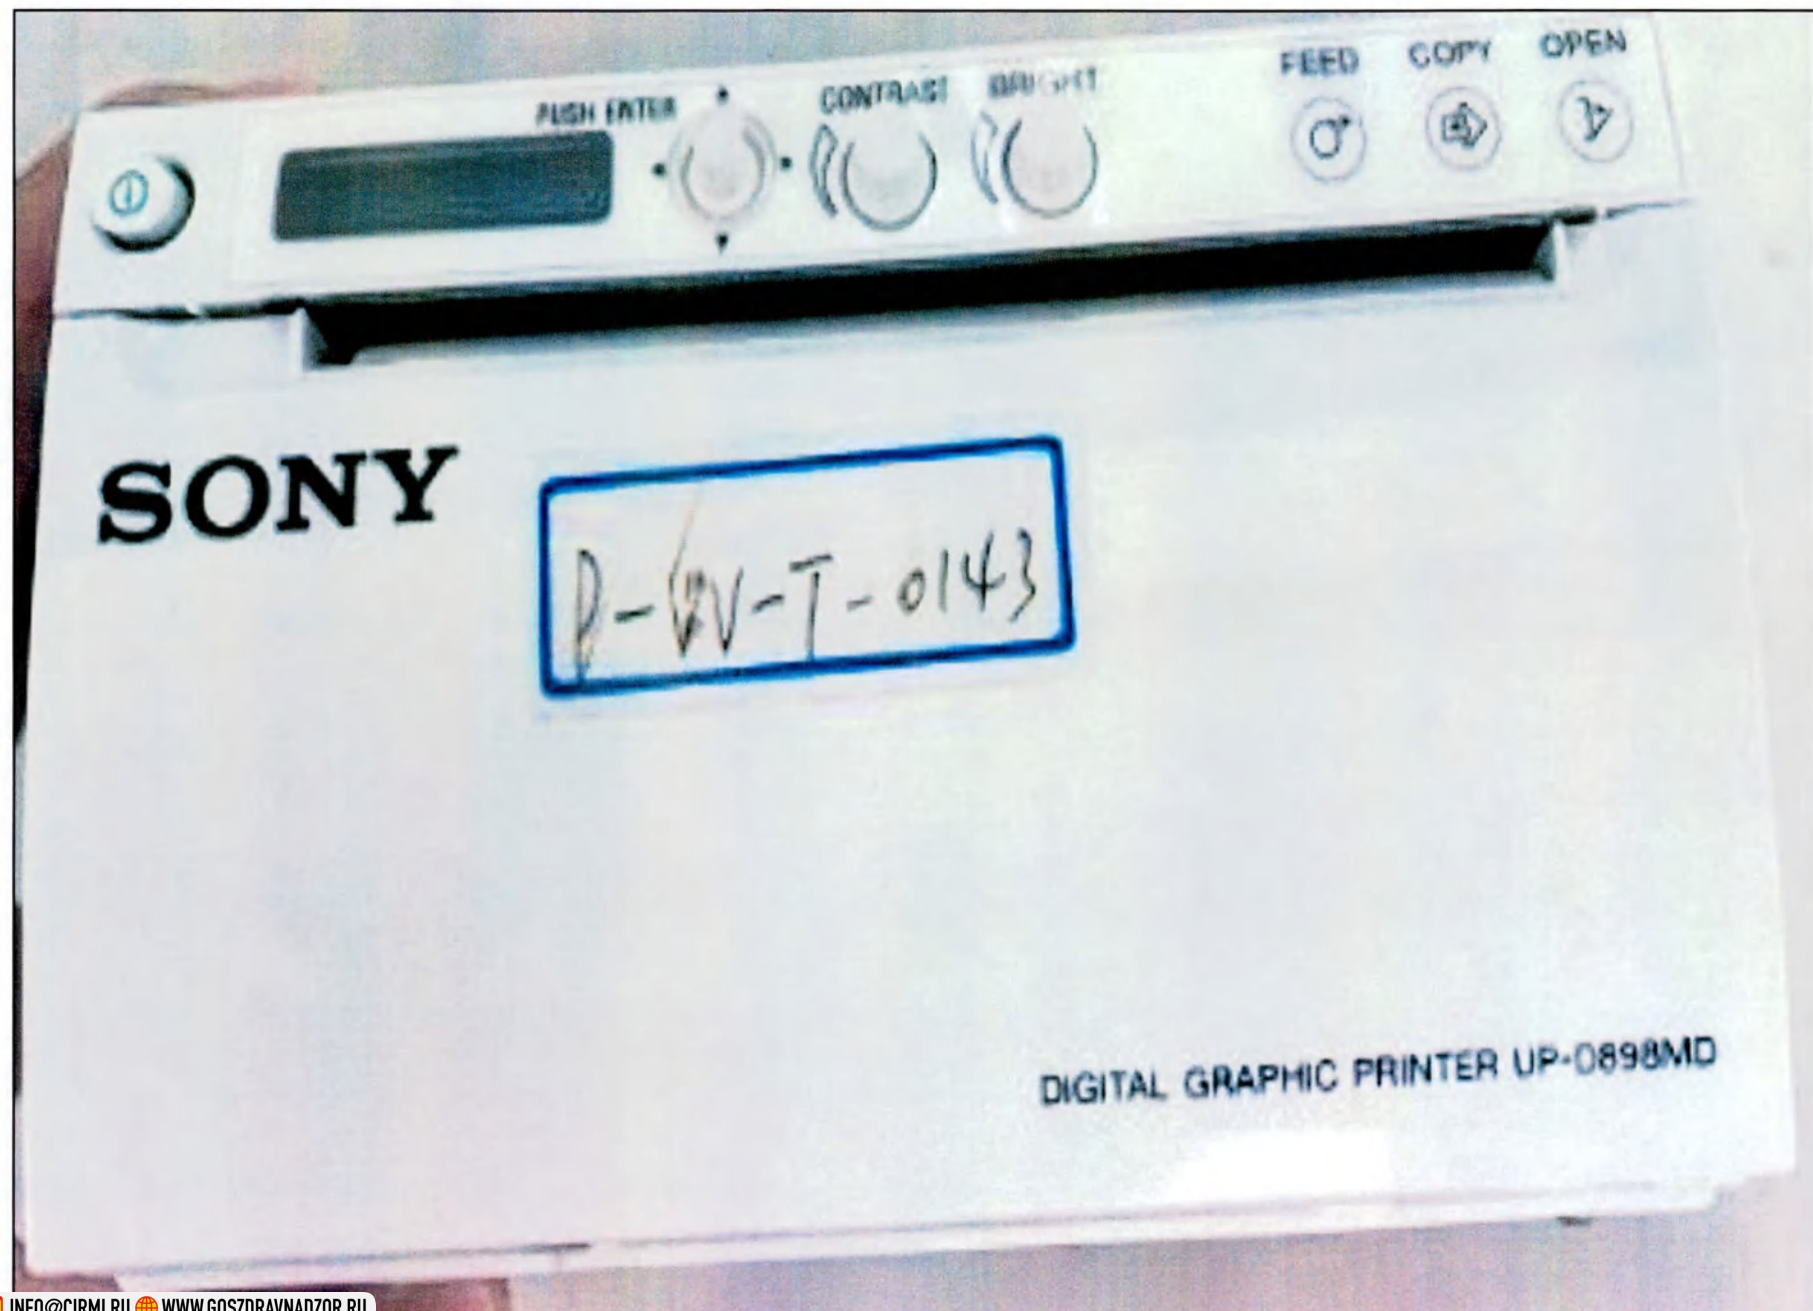

Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения и текст, UP-D25MD в комплекте с кабелями для подключения или без них.



Макет маркировки для Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения и текст в комплекте с кабелями для подключения или без них

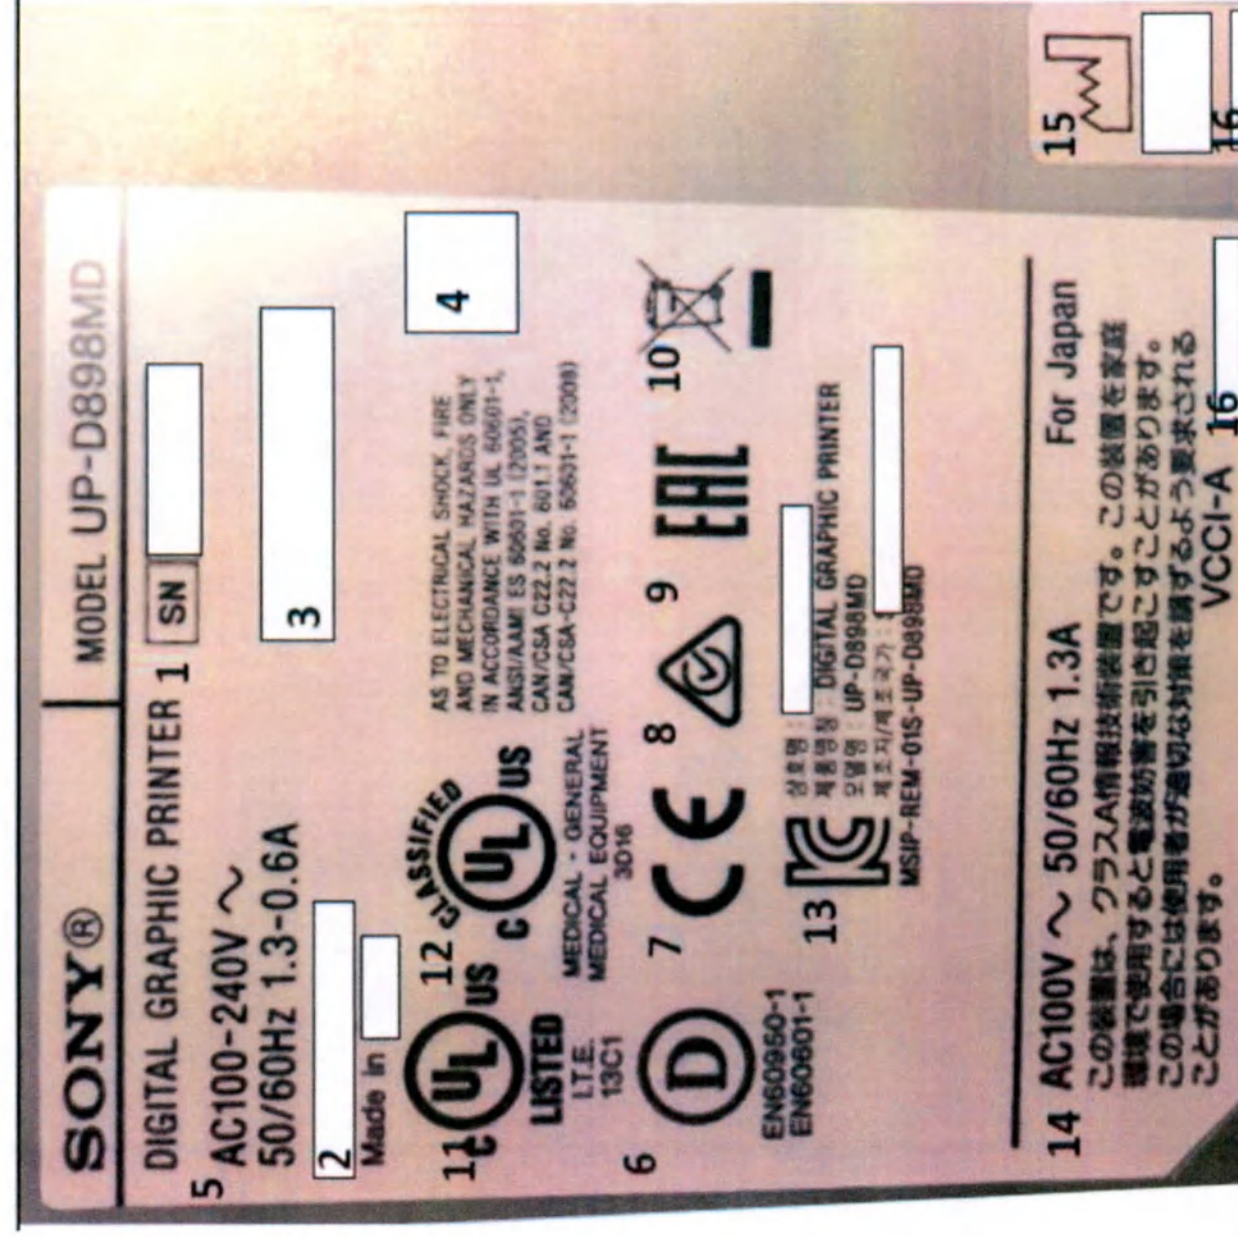


Макет маркировки Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения и текст в комплекте с кабелями для подключения или без них.



Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения.



Макет маркировки Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения.

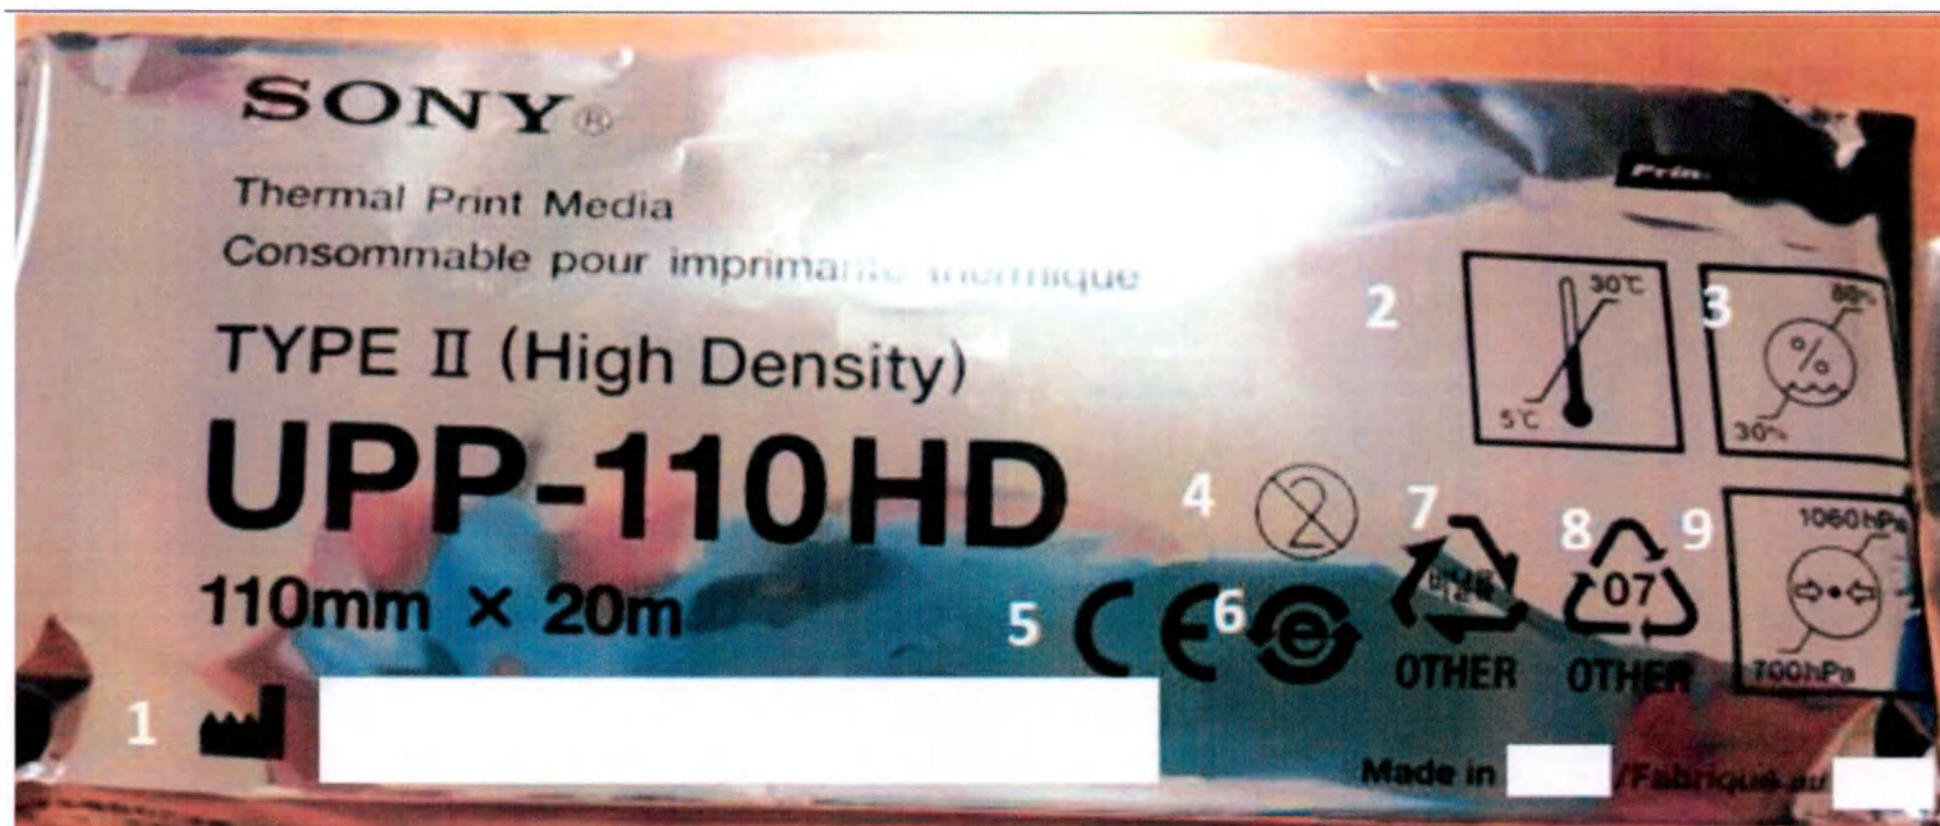

Полка для крепления принтера на тележке.



Макет маркировки для Полка для крепления принтера на тележке, Кабель для подключения внешних источников физиологических сигналов, Дополнительные держатели для датчиков, Защитная пленка для панели оператора, Полки для установки дополнительного оборудования: Полка для установки дополнительного оборудования, передняя; Полка для установки дополнительного оборудования, задняя верхняя; Полка для установки дополнительного оборудования, задняя нижняя.

1 PARTS NO :

2 REV.

4 


3 PARTS NAME :

5 Q'TY :


Подставка для системы Vivid IQ.




Руководство пользователя на английском языке.

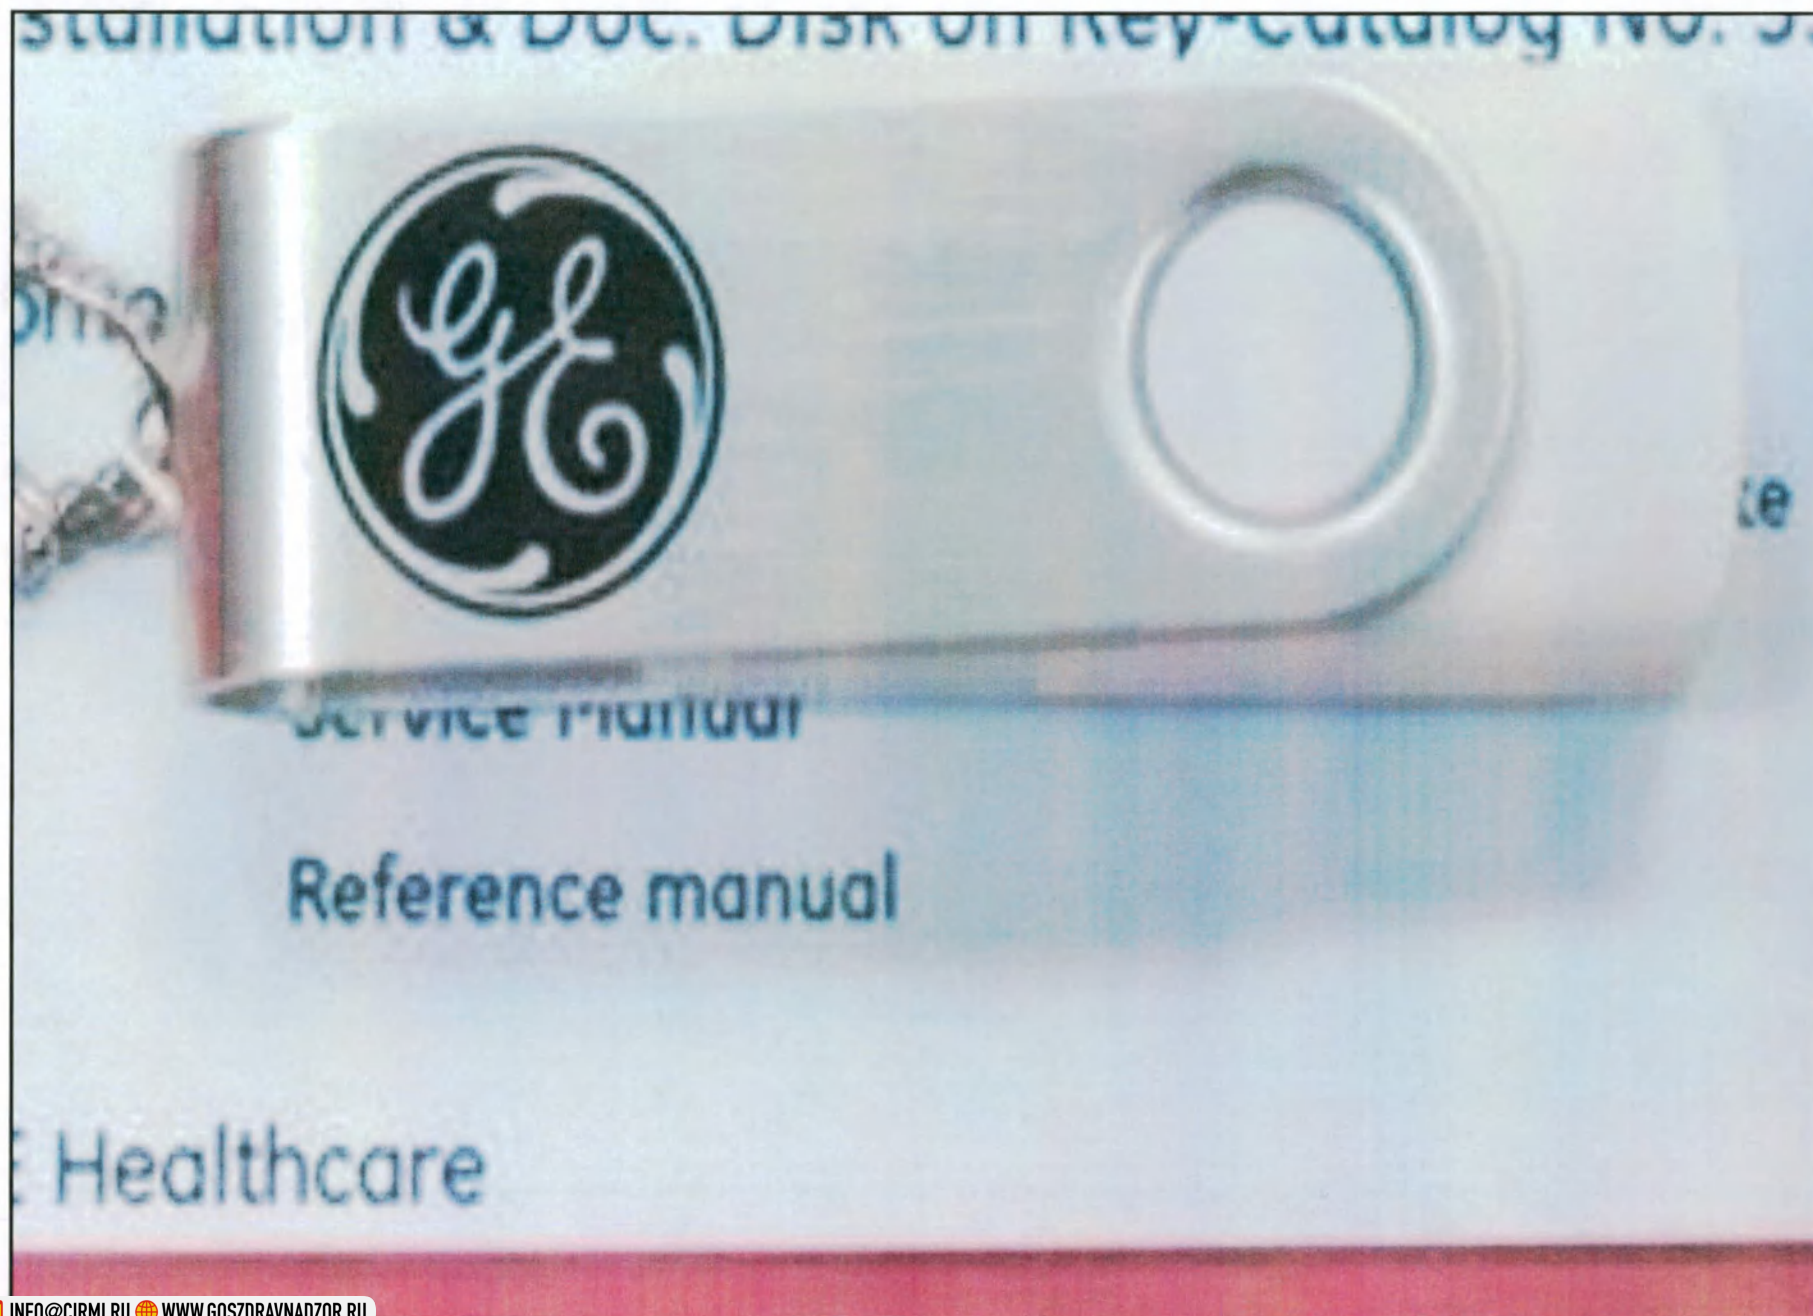

Буклет, краткое руководство пользователя на английском языке.

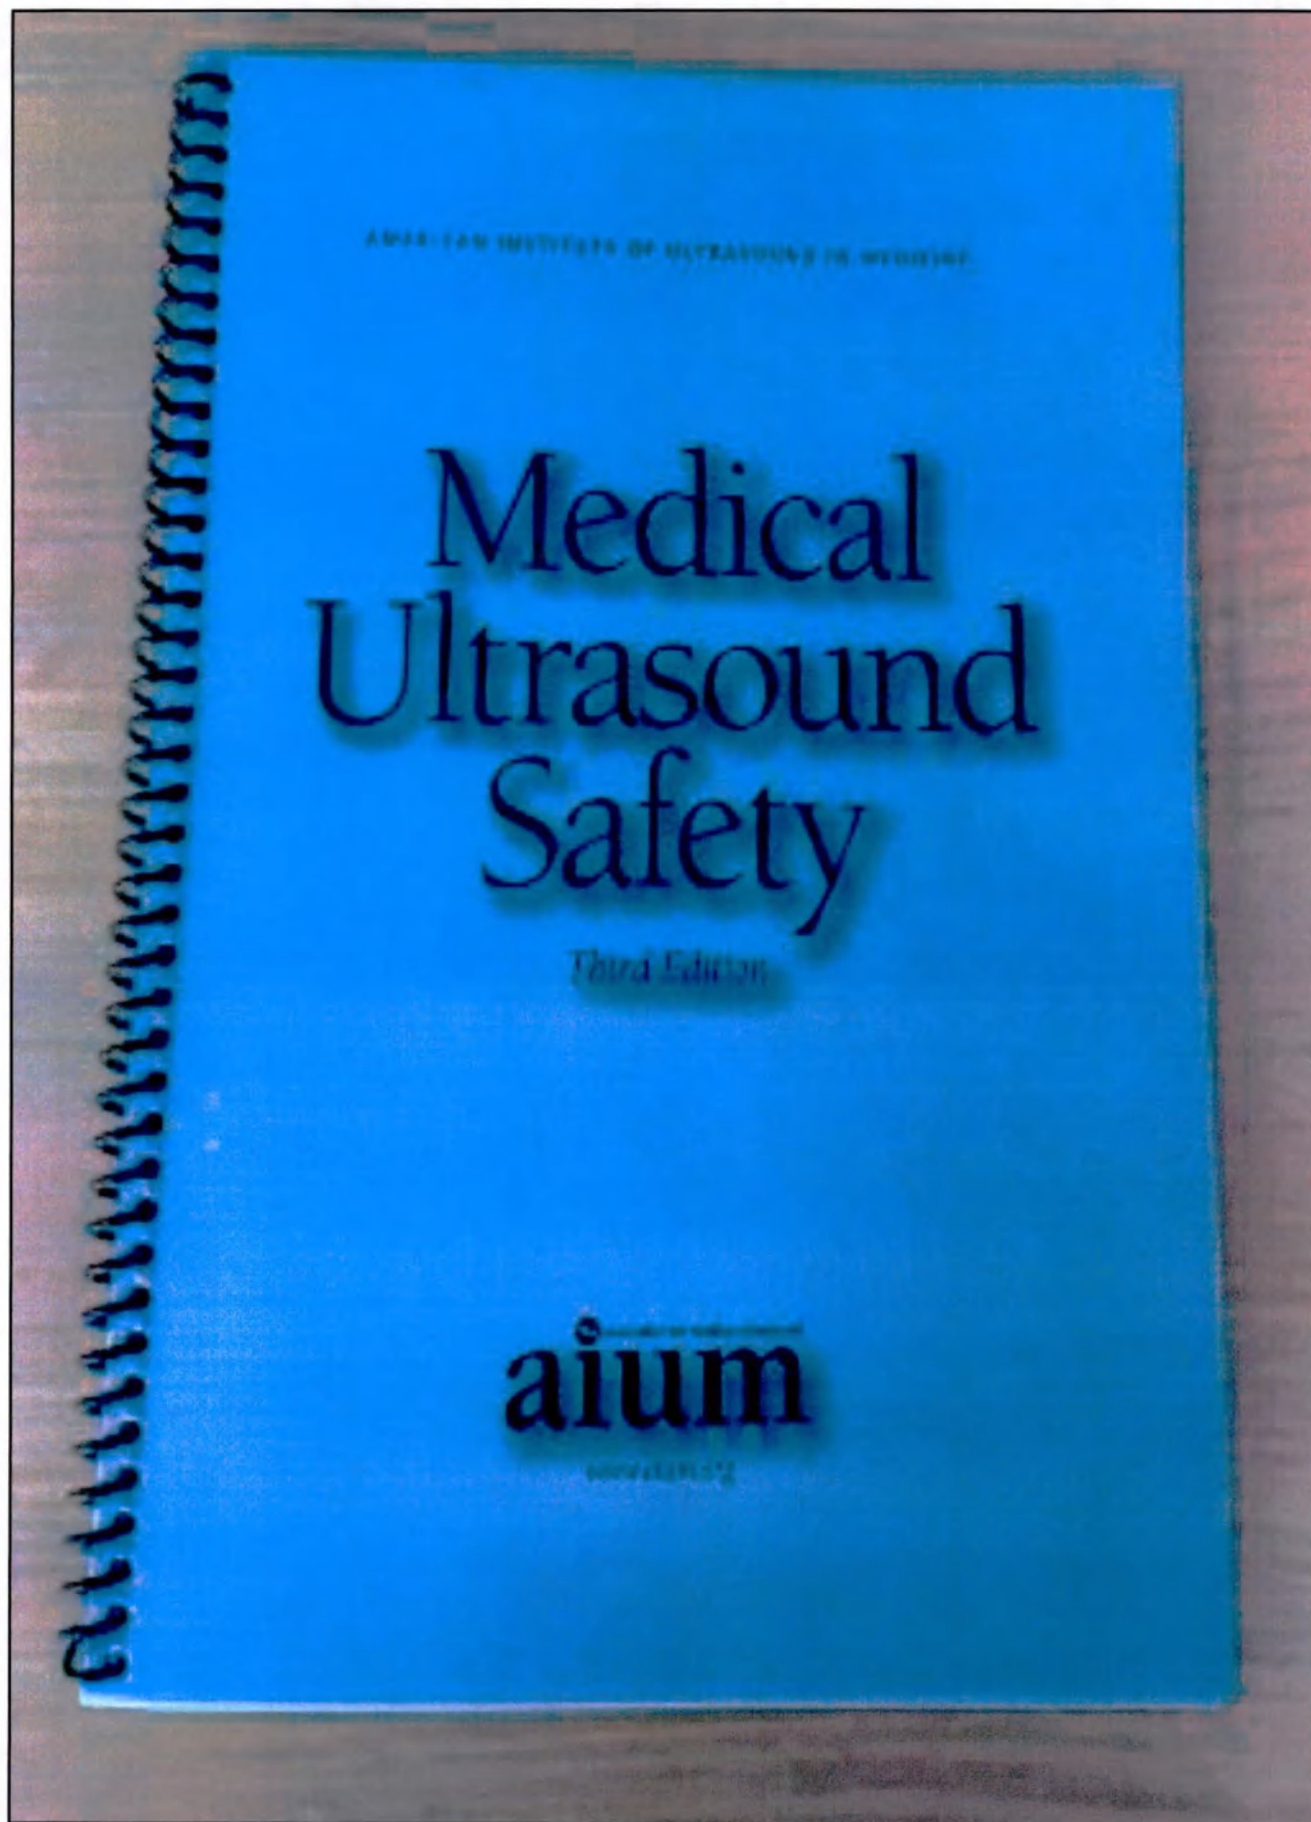

Инструкция пользователя для тележки.

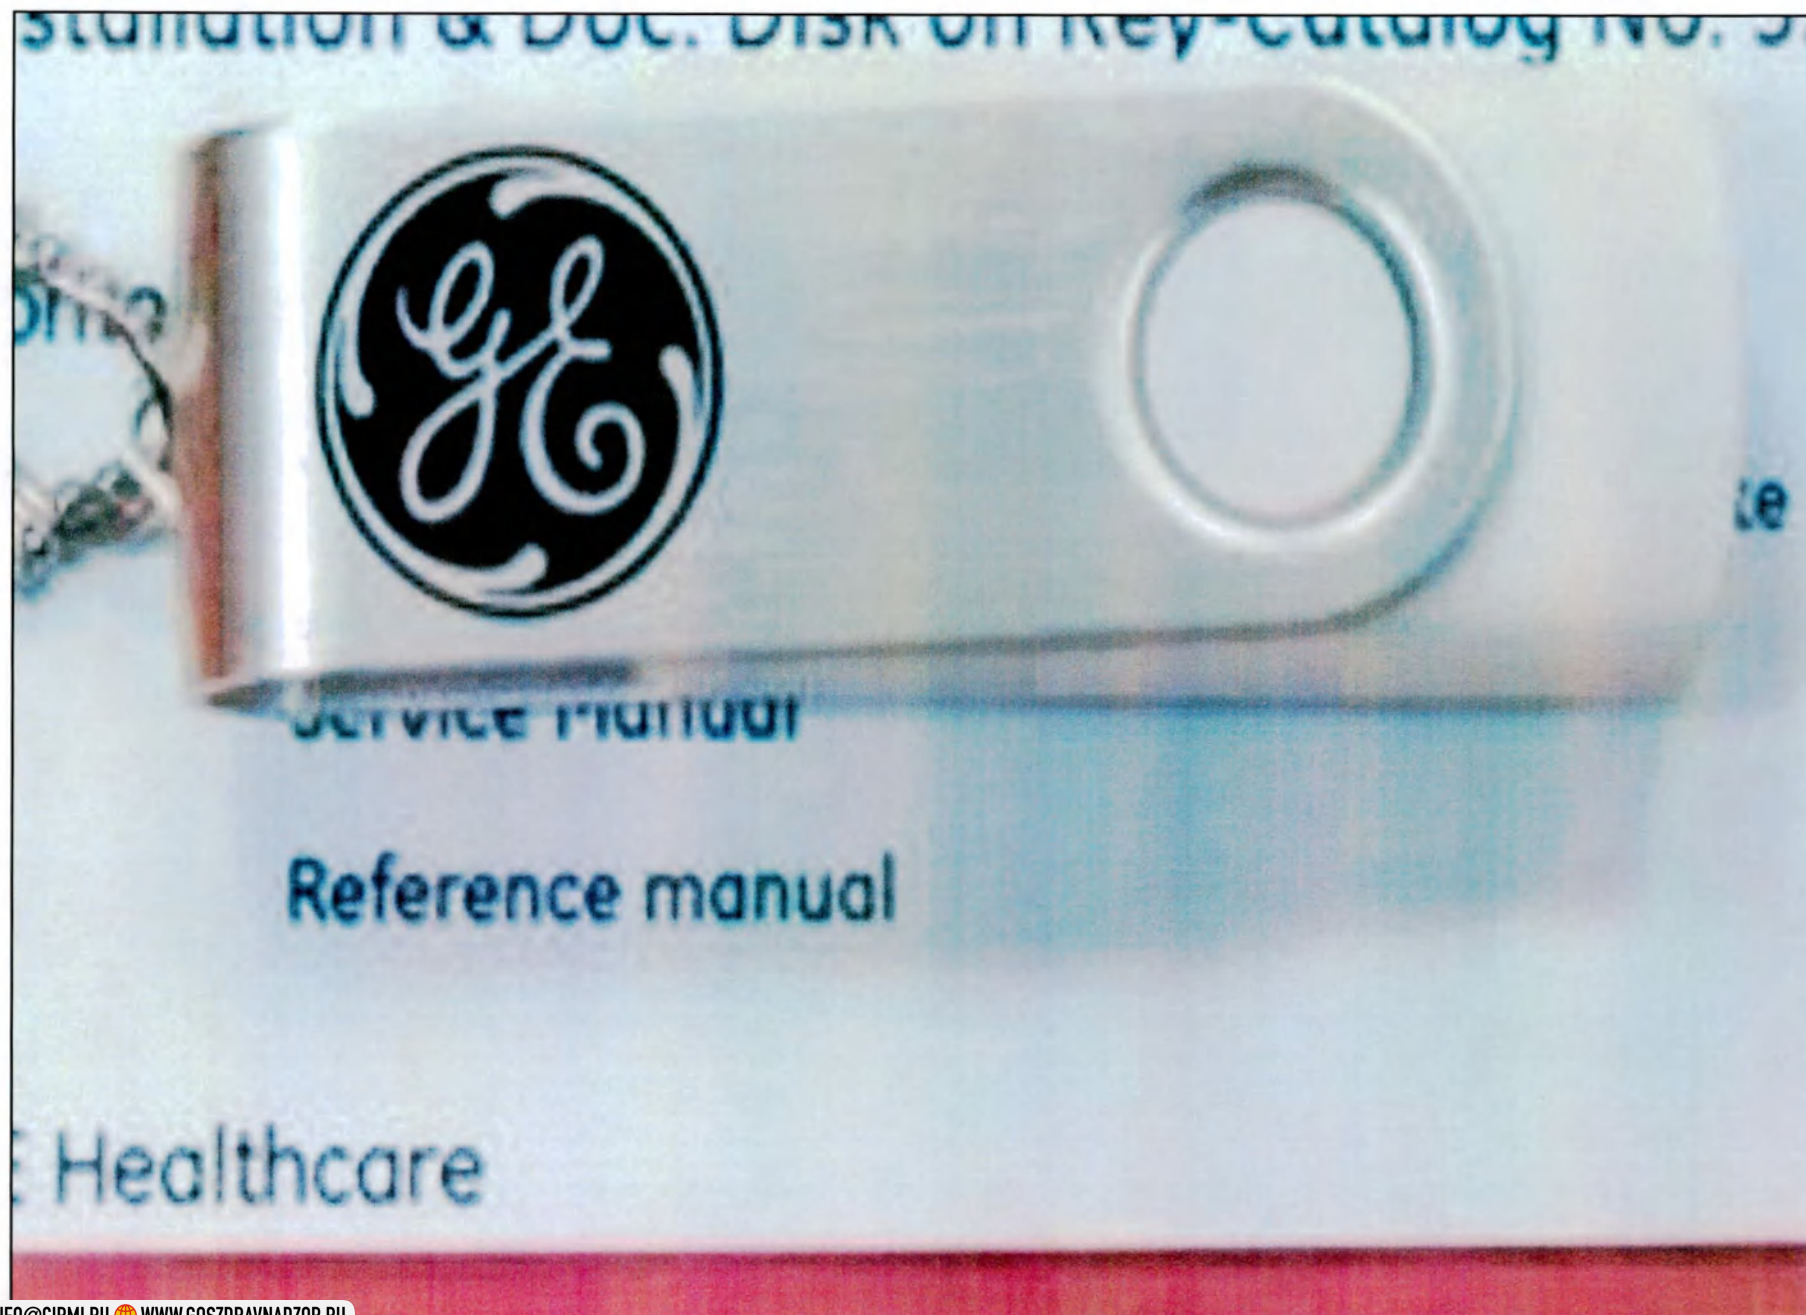

Дополнительный кабель электропитания.



Дополнительный сетевой адаптер переменного тока для консоли.



Блок аккумуляторов для тележки.



Макет маркировки Блок аккумуляторов для тележки

1  2 DESC.:

名称: 可移动式推车大电池盒
Model/型号:

3

4 REF

5 SN

6 

生产日期:

7 

8  使用期限: 7年


生产企业名称: 通用电气医疗系统(中国)有限公司
生产地址: 无锡国家高新技术产业开发区长江路19号
邮编214028

9 中国制造

Программное обеспечение для модернизация до версии Vivid iq Premium на CD диске или USB флеш карте.



CD-диск или USB флеш карта с инструкцией пользователя на нескольких языках.

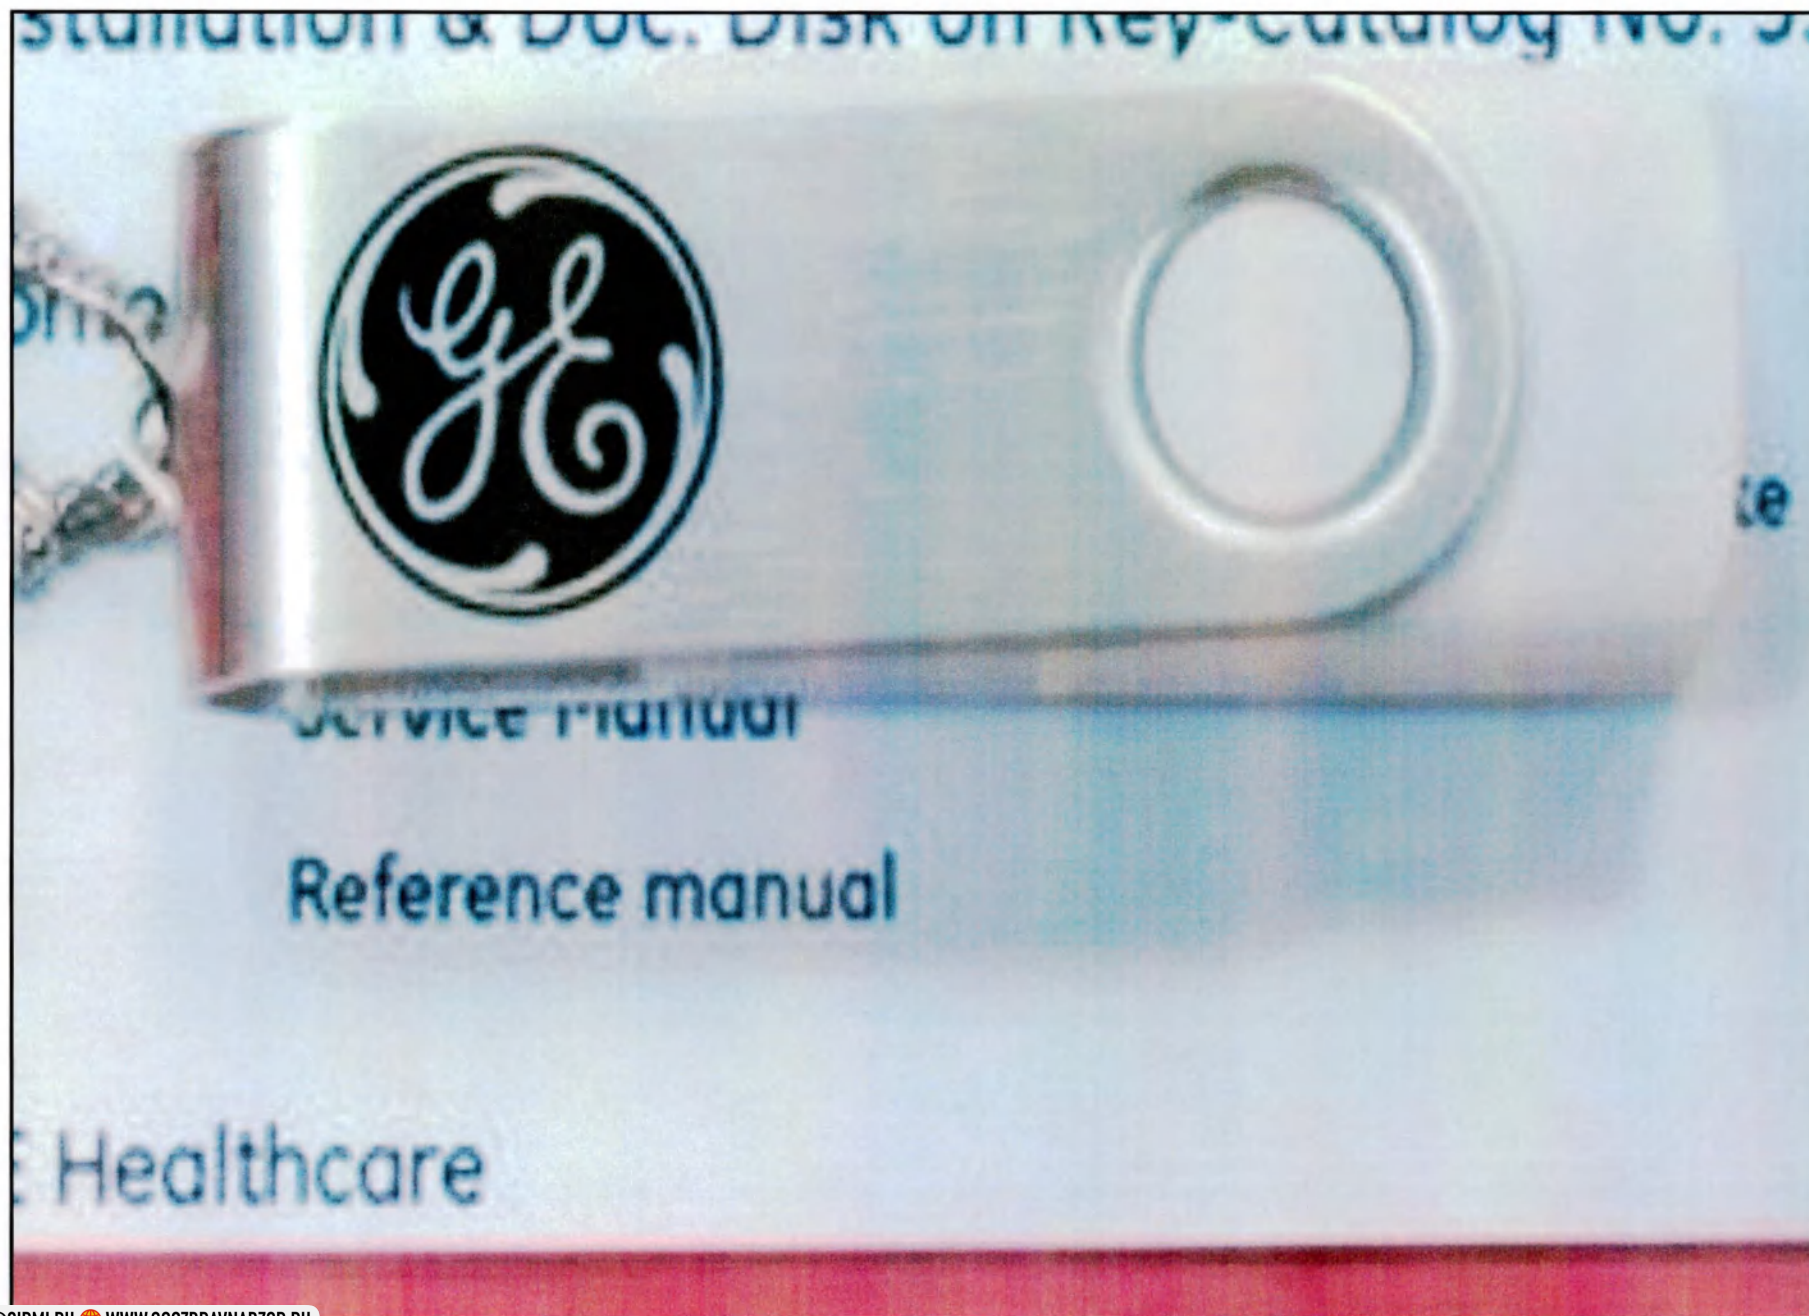


Программное обеспечение для модернизация до версии Vivid iq 4D на CD диске или USB флеш карте.



Программное обеспечение для модернизации ультразвуковой консоли на CD диске или USB флеш карте.



Электронный ключ для активации программного модуля для доступа к облачной платформе Tricefy, для архивации данных исследования, а также просмотра и использования их вместе с коллегами и пациентами на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

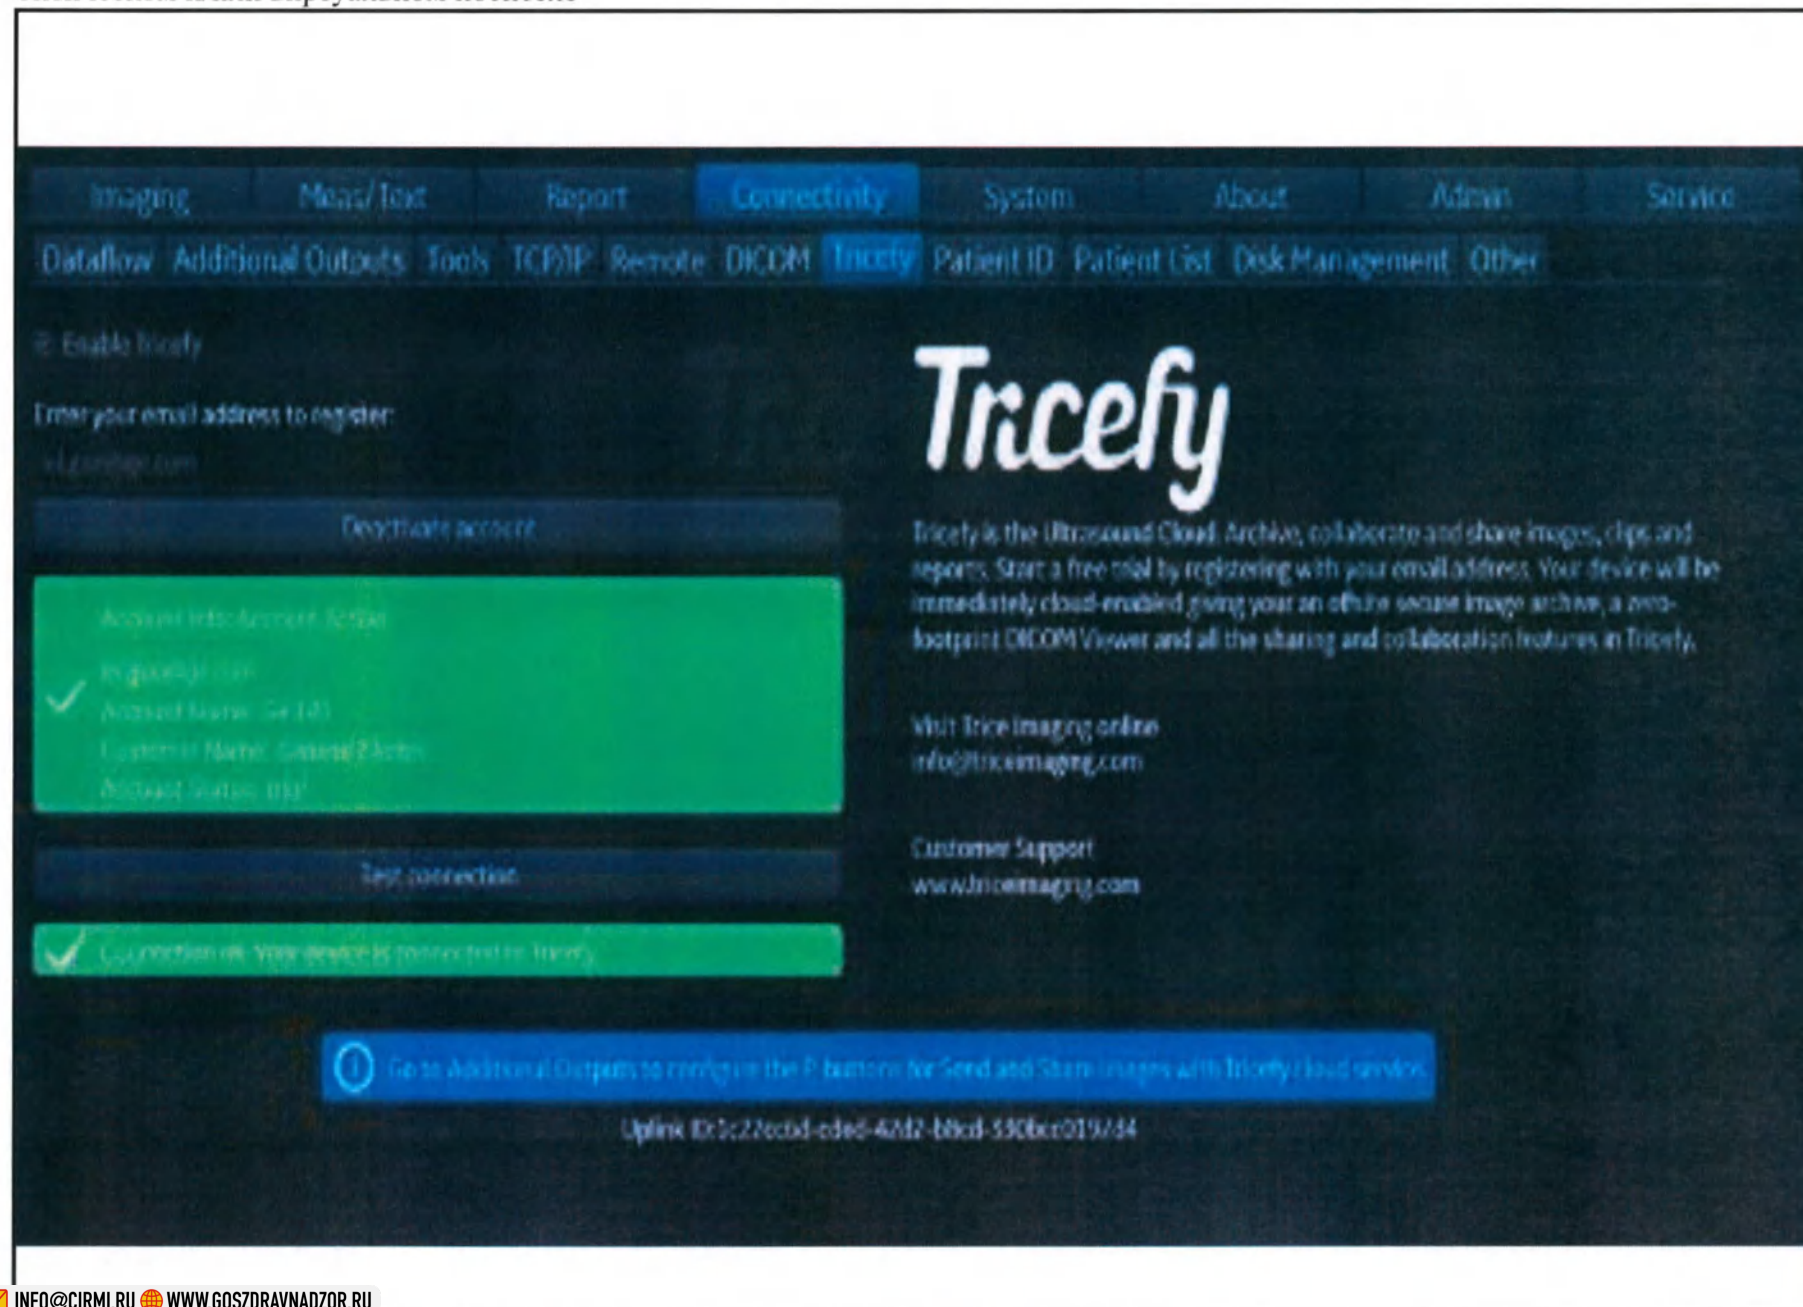



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

156

Александр листа(ов)

