

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Аппарат физиотерапевтический для диатермии INDIBA
ACTIV**

INDIBA, S.A.U. («ИНДИБА С.А.У»), Испания

2024




Общий вид изделия в варианте исполнения INDIBA Activ701

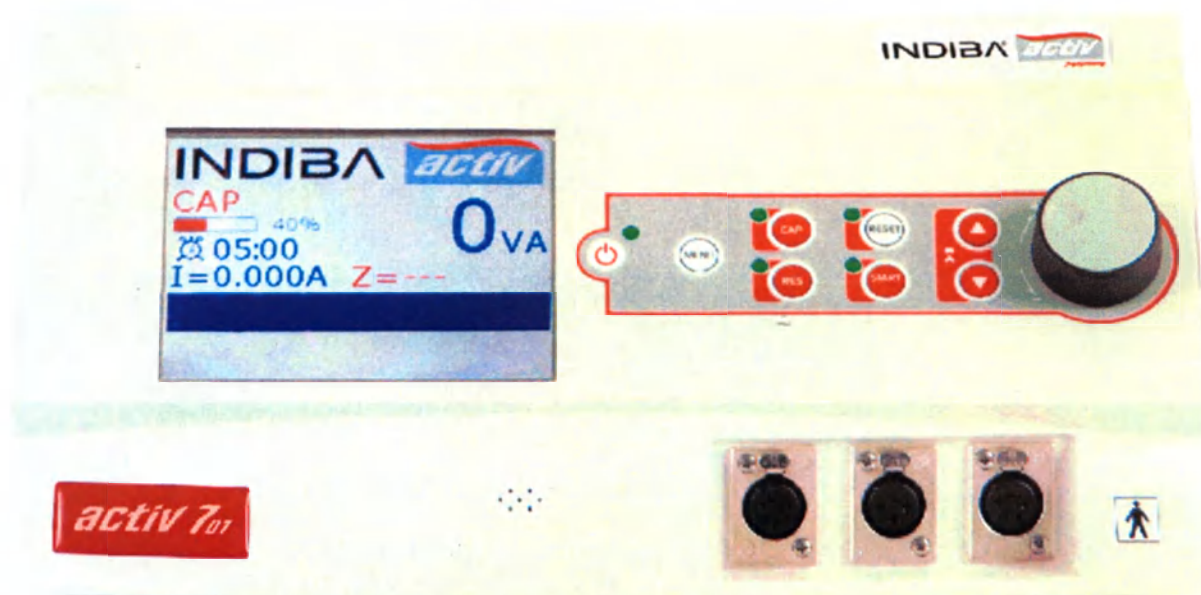

Внешний вид блока основного в варианте исполнения INDIBA Activ701




Общий вид изделия в варианте исполнения INDIBA Activ801

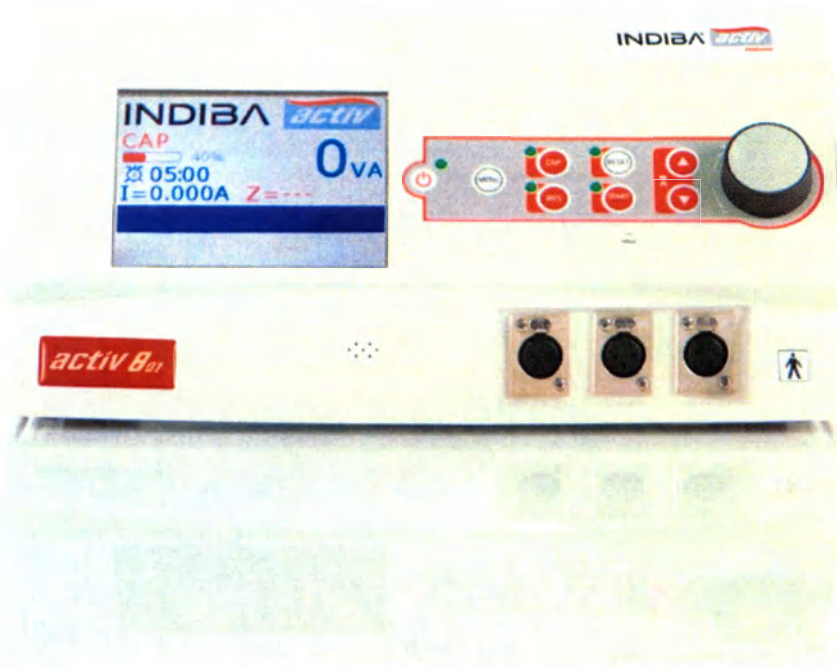

Внешний вид блока основного в варианте исполнения INDIBA Activ801



Общий вид изделия в варианте исполнения INDIBA Activ9₀₂

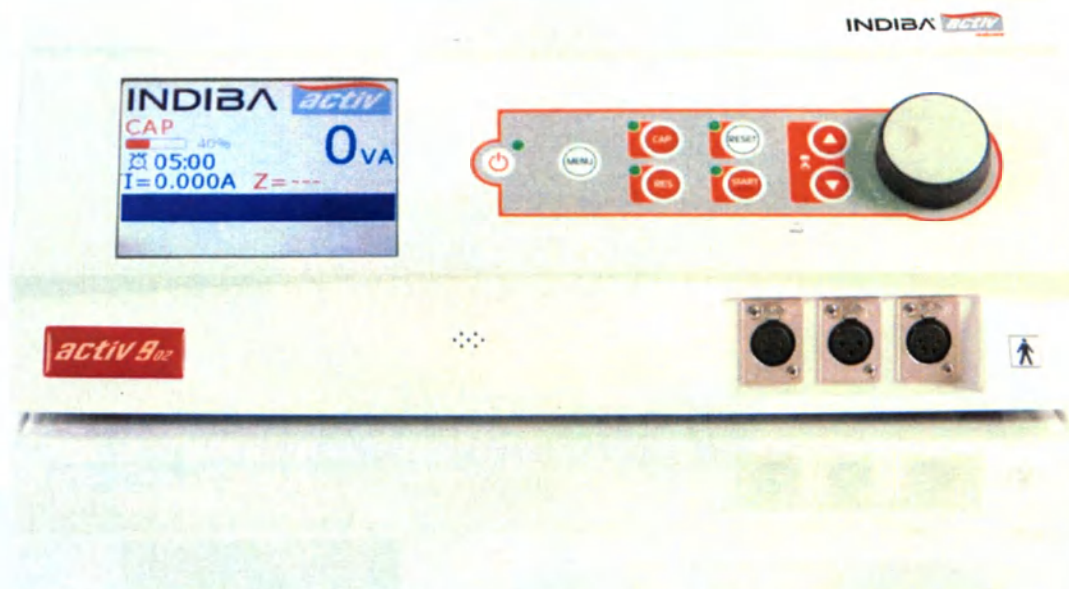

Внешний вид блока основного в варианте исполнения INDIBA Activ9₀₂



Общий вид изделия в варианте исполнения Activ CT8, Activ CT9 (блок основной размещен на стойке-тележке)



Внешний вид блока основного в варианте исполнения Activ CT8, Activ CT9 (вид сверху с закрытой крышкой)




Внешний вид блока основного в варианте исполнения Activ CT8, Activ CT9 (вид сверху с открытой крышкой)




Внешний вид блока основного в варианте исполнения Activ CT8, Activ CT9 (вид спереди)




Экранированный кабель питания

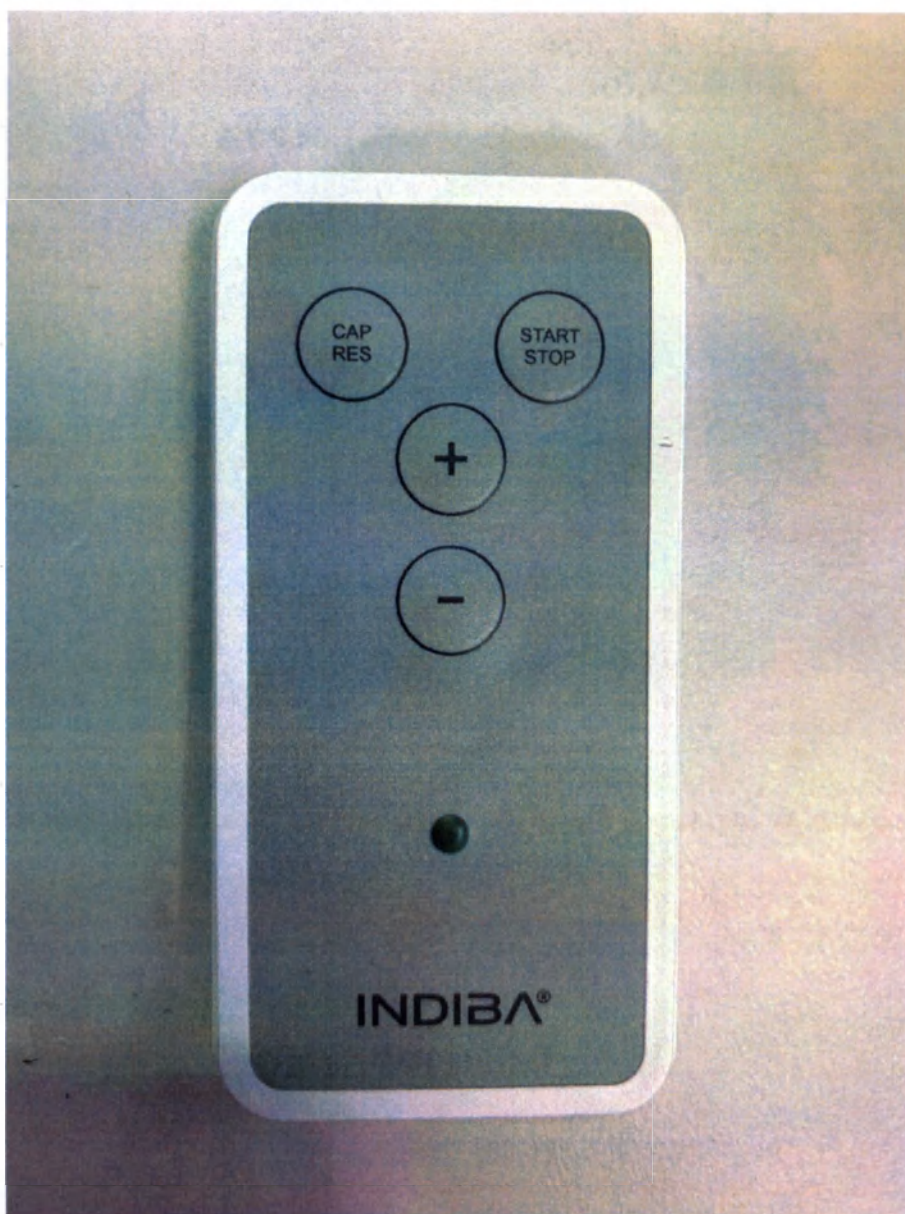

Пульт управления

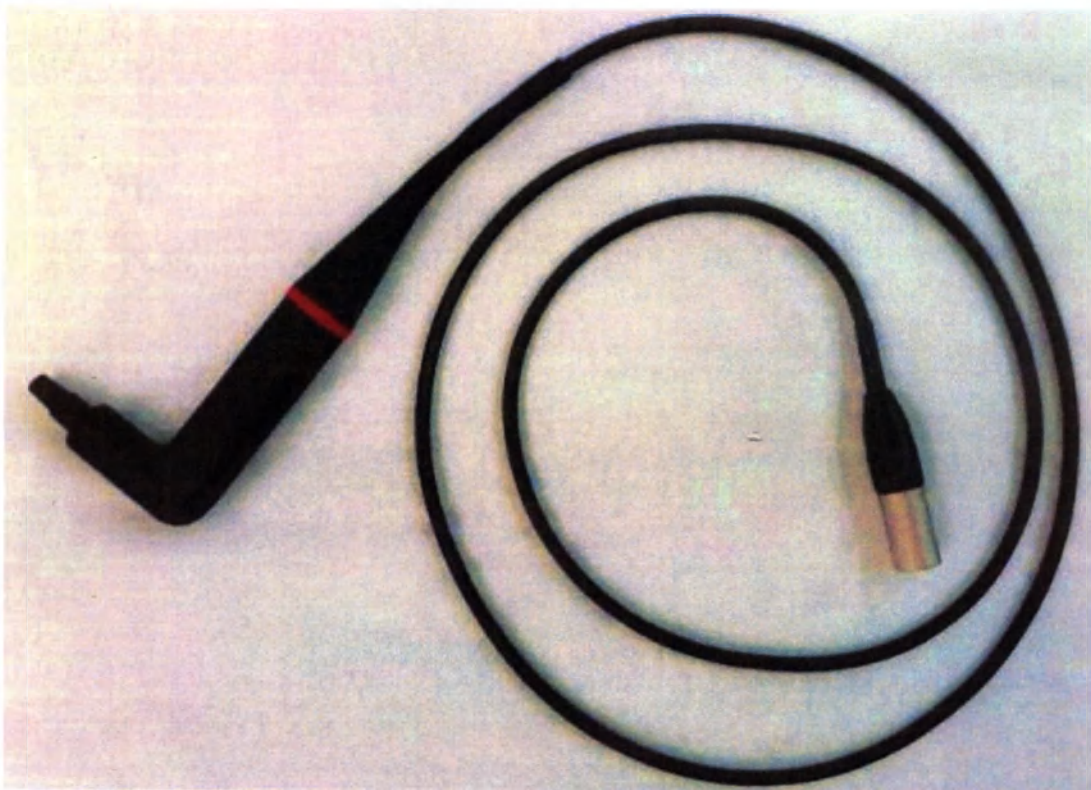

Рукоятка изогнутая для электрода САР/ Изогнутый держатель «САР» с кабелем

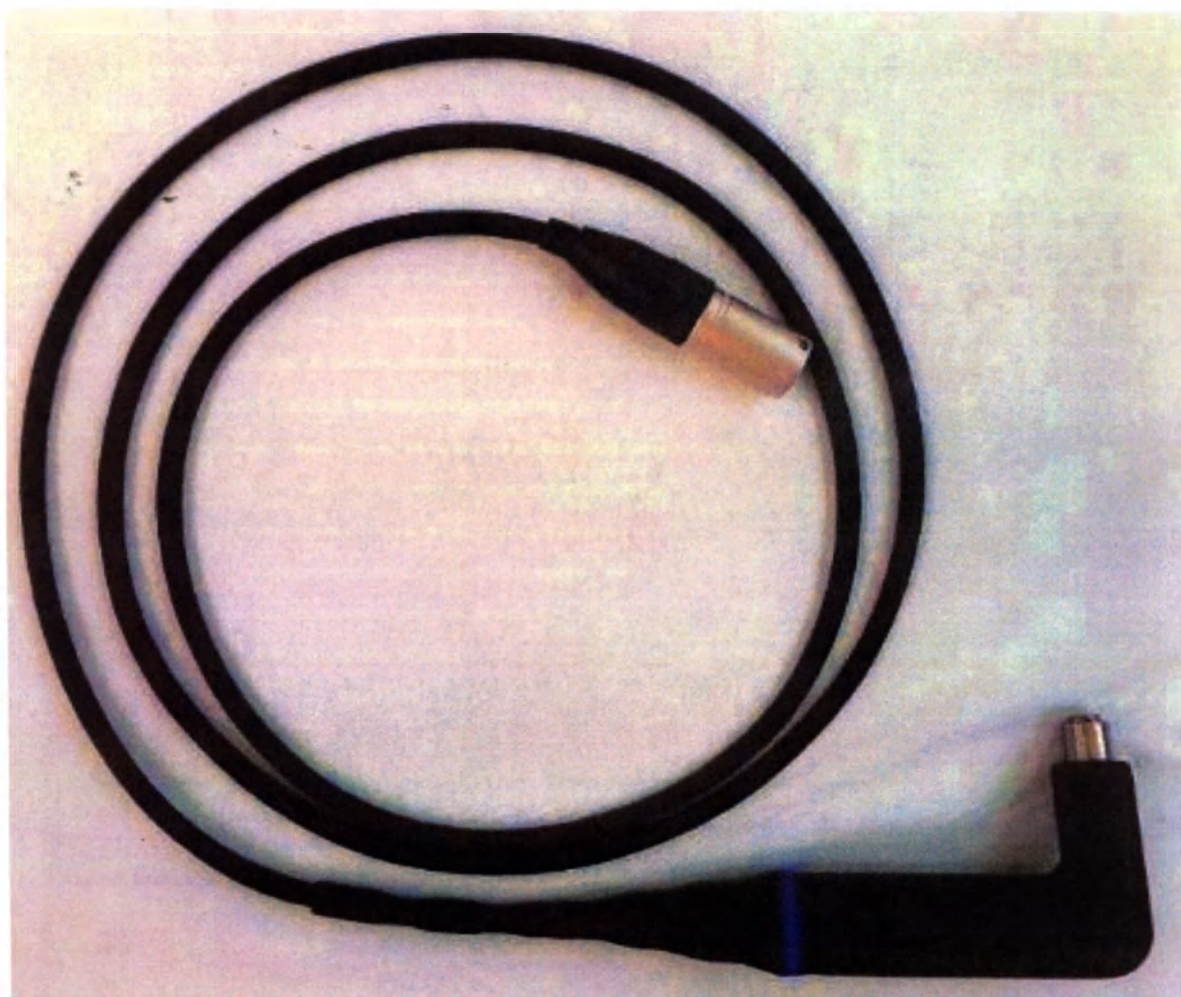

Рукоятка изогнутая для электрода RES/ Держатель «RES» с кабелем



Рукоятка прямая для электрода САР/ Прямой держатель «САР» с кабелем




Электрод возвратный плоский/ Возвратная пластина




Электрод возвратный цилиндрический



Кабель электрода возвратного цилиндрического

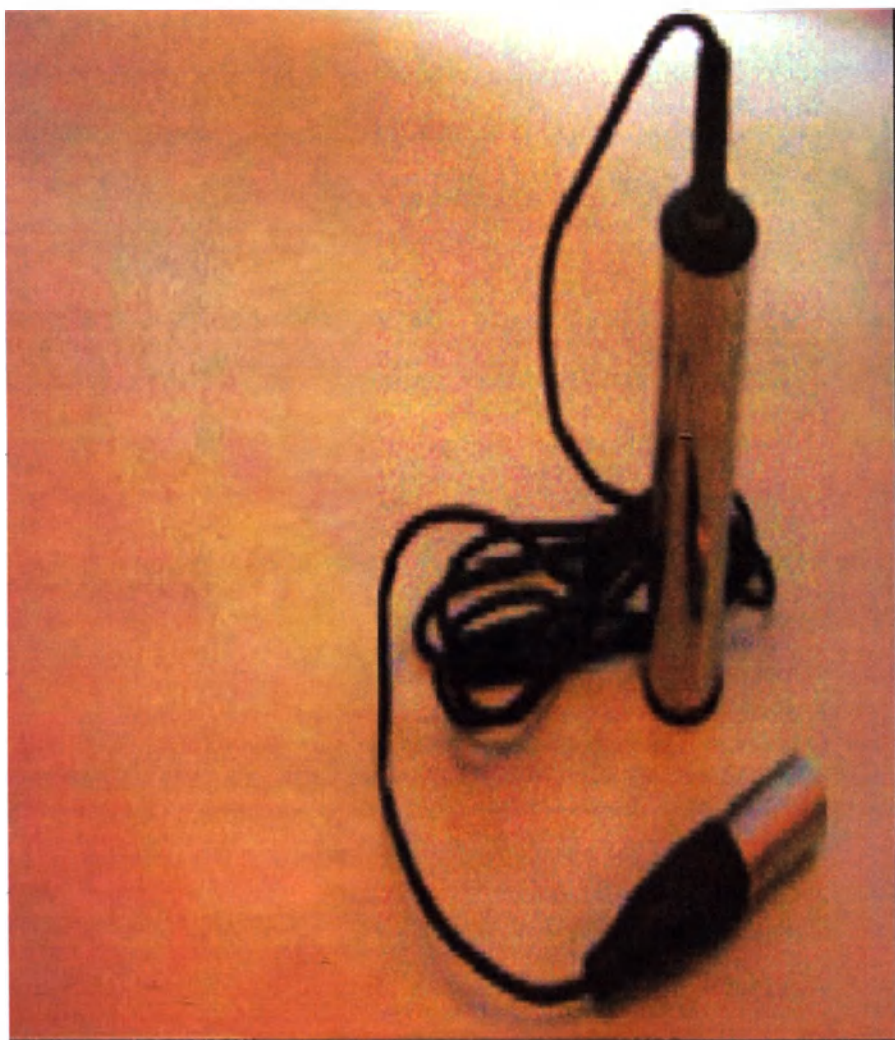


Цилиндрический нейтральный электрод с кабелем

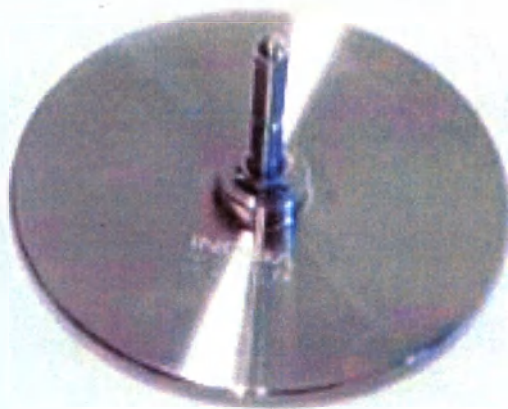

Электрод RES (слева) и CAP (справа) (также могут называться резистивный и емкостной электроды соответственно)



Устройство URC для связи с аппаратом INDIBA ACTIV (для вариантов исполнения INDIBA Activ 701, Acitiv 801, Acitiv 901).

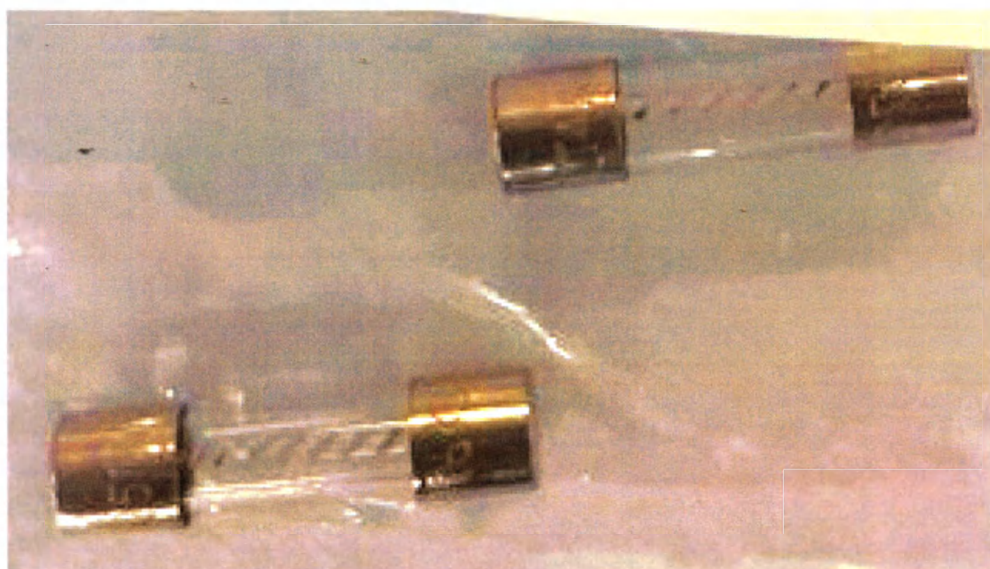

Предохранитель




Крем проводящий INDIBA PROIONIC ACTIV CREAM 1000 mL



Флеш-память USB с ПО и руководством пользователя

REF	/вариант исполнения/	SN
Аппарат физиотерапевтический для диатермии INDIBA ACTIV		
Питание :		
Входная мощность :		
Предохранители :		
Максимальная полная выходная мощность в режиме RES:		
Максимальная полная выходная мощность в режиме CAP:		
		MD
		
		
		
UDI		
		ру № - от
 INDIBA, S.A.U. («ИНДИБА С.А.У»), Испания Moianès, 13, Pol. Ind. Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Spain		
LBL16066 V3L		

Проект маркировки блока основного

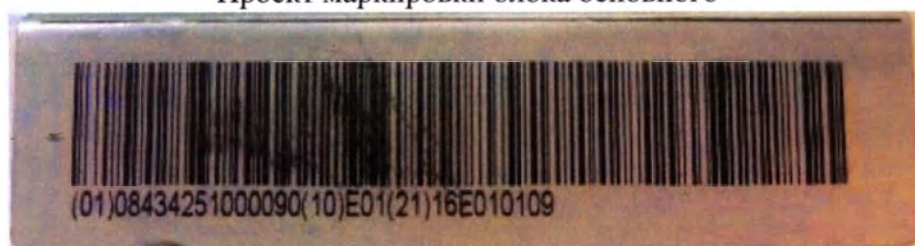

Маркировка на задней стороне аппарата, содержащая уникальный идентификационный номер изделия



Транспортная упаковка блока основного

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 18 листа (-ов)

Генеральный Директор Н / Носова Т.А.

М.П.



МИТРОХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АД6134547