



ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Made For life

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Система для медицинской визуализации
Vitrea® Advanced Visualization с принадлежностями*

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АрПи Канон Медикал Системз»



Д.В. Чередниченко
шюня 2024 г.
М.П.

119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1, этаж 5, ком. 129
Телефон +7 (495) 626 5809, +7 (495) 921 4948
<https://rp.medical.canon>

Основной состав.

1. Программное обеспечение основное Vitrea® Advanced Visualization, не более 100 шт.:

Витреа-Админ

списка исследований...

Поиск

Фамиль. ио

Учреждение:

ИД пациента:

ФИО пациента:

Дата рождения:

Учетный номер:

Описание исследования:

Модальность:

Дата исслед:

Поиск

Результаты

Включите в поиск Модальность СТ Дата исслед Любая Сост Любая в архиве default

Сост	ИД пациента	Пол	Число изображ.	Дата/время исслед.	Возраст	Открыть
	09.2021	F	3300	23 Сент 2021 08:37	61y	
	1889	F	801	27 Янв 2021 15:11	42y	
	108	M	722	01 Февр 2021 16:37	69y	
	0410936	F	562	23 Сент 2021 11:41	70y	
	300918350170	M	1852	08 Март 2021 12:02	70y	
	219/21	F	10047	11 Июнь 2021 16:40	34y	
	623	M	2503	15 Апр 2022 11:08	58y	
	160428699	F	716	01 Апр 2020 08:44	51y	

Последнее обновление: 7 мес. назад Всего результатов: 23

Приложение

Результаты


Исх.

1 46 52 53 60 Long modules 2 | 1809474486 | — | 24 Янв 2022 15:16


Инстр. | Связки | Изображения

Сост	Сериал	Физ. изображений	Дата/время исследования
	1173522	751	
	1175047	751	
	1173629	1	
	1173630	401	
	1175135	1	
	1175156	401	
	1173544	482	
	1173544	1	
	1175110	482	
	1175110	1	
	6	401	24 Янв 2022 15:18:21
	11	482	24 Янв 2022 15:18:34
	14	751	24 Янв 2022 15:20:12
	17	750	24 Янв 2022 15:20:31
	500	1	14 Дек 2022 10:00:43
	501	1	20 Дек 2022 11:02:31
	502	1	23 Дек 2022 11:17:06
	502	1	23 Дек 2022 11:17:39
	502	1	23 Дек 2022 11:18:51


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.1 Приложение для Мульти-модального просмотра

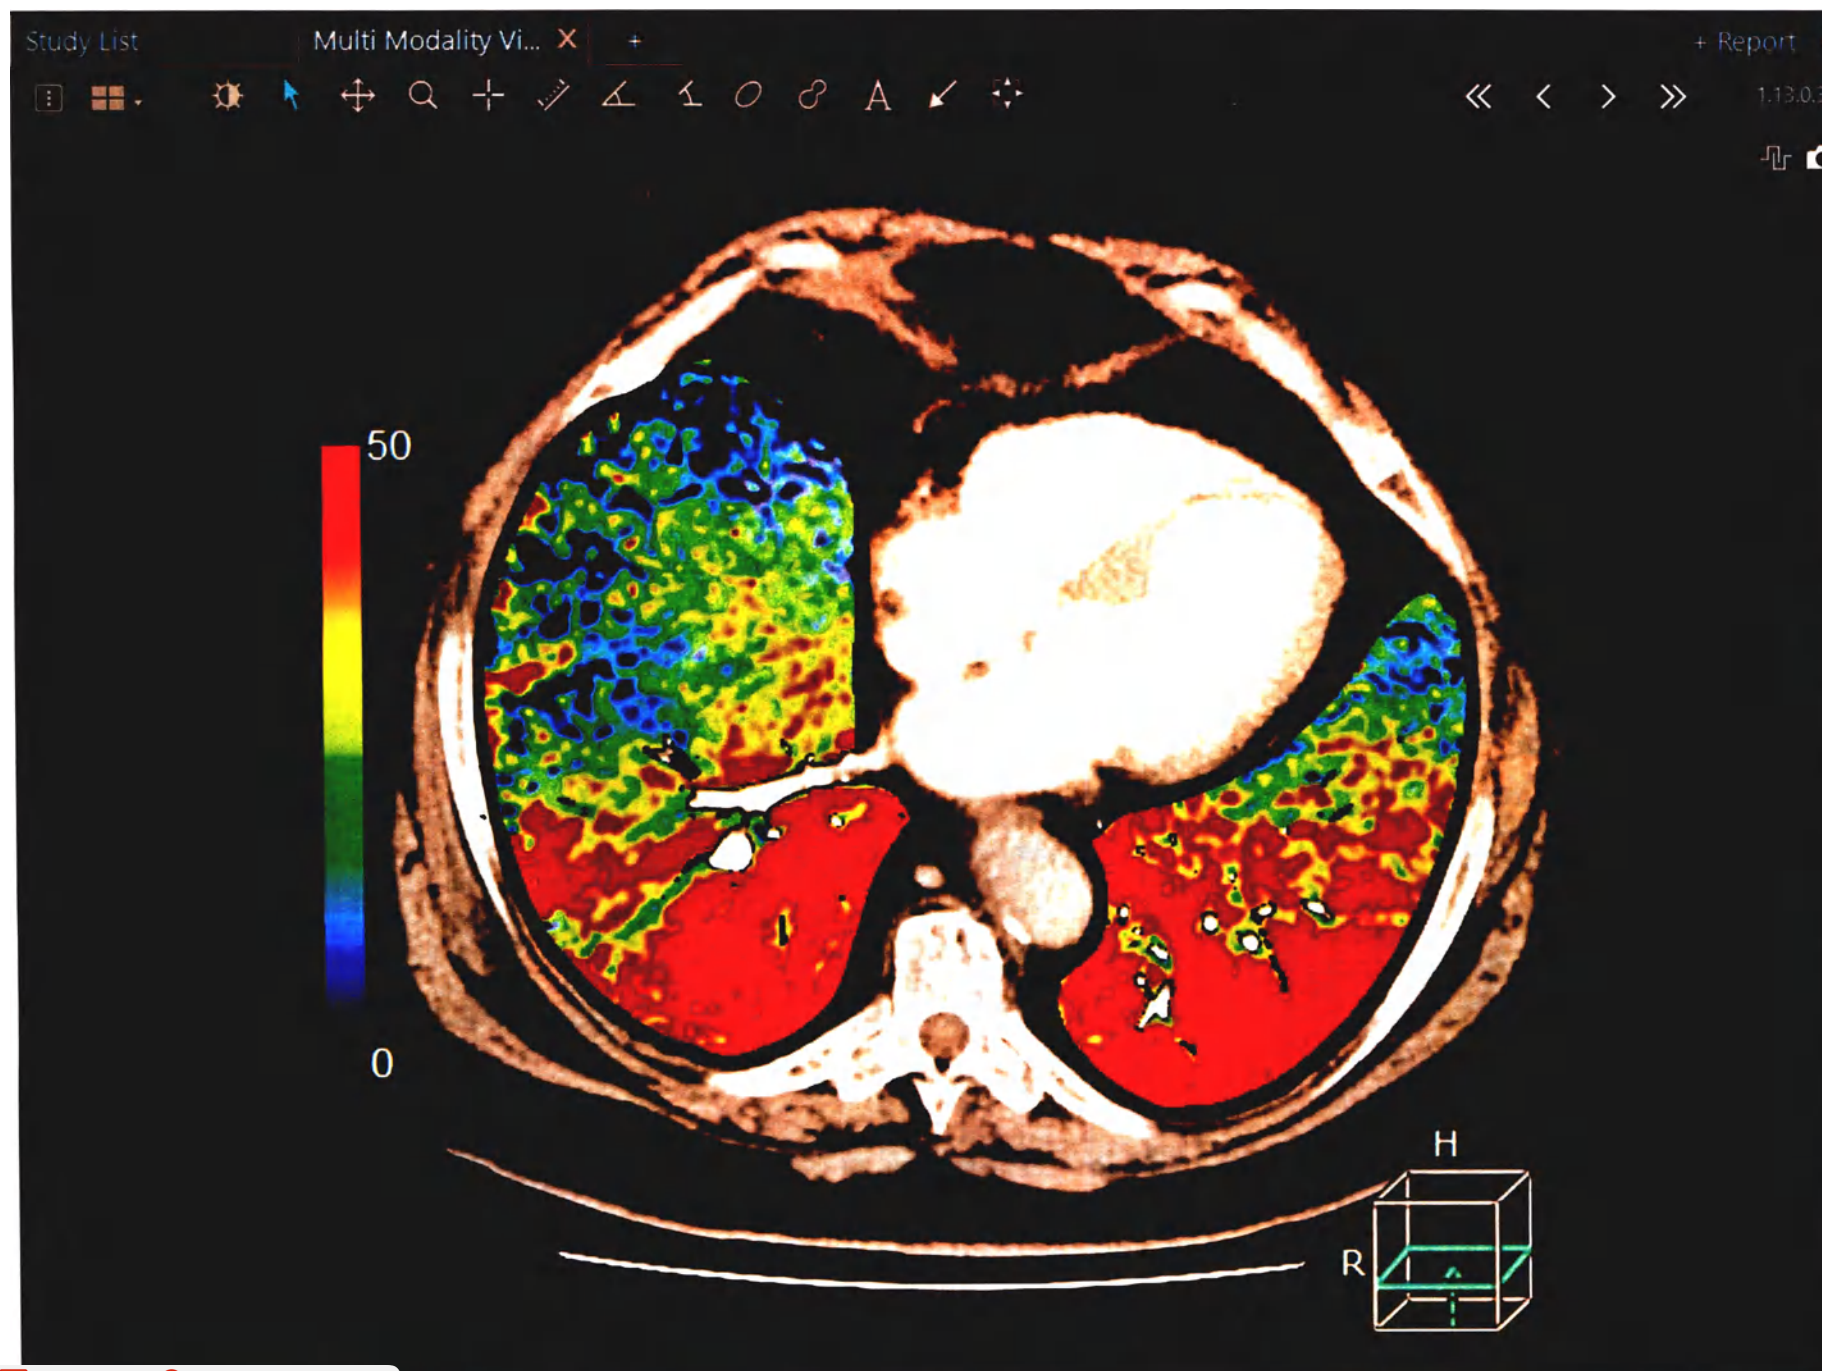


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.2 Приложение для 3D-мультипланарного просмотра

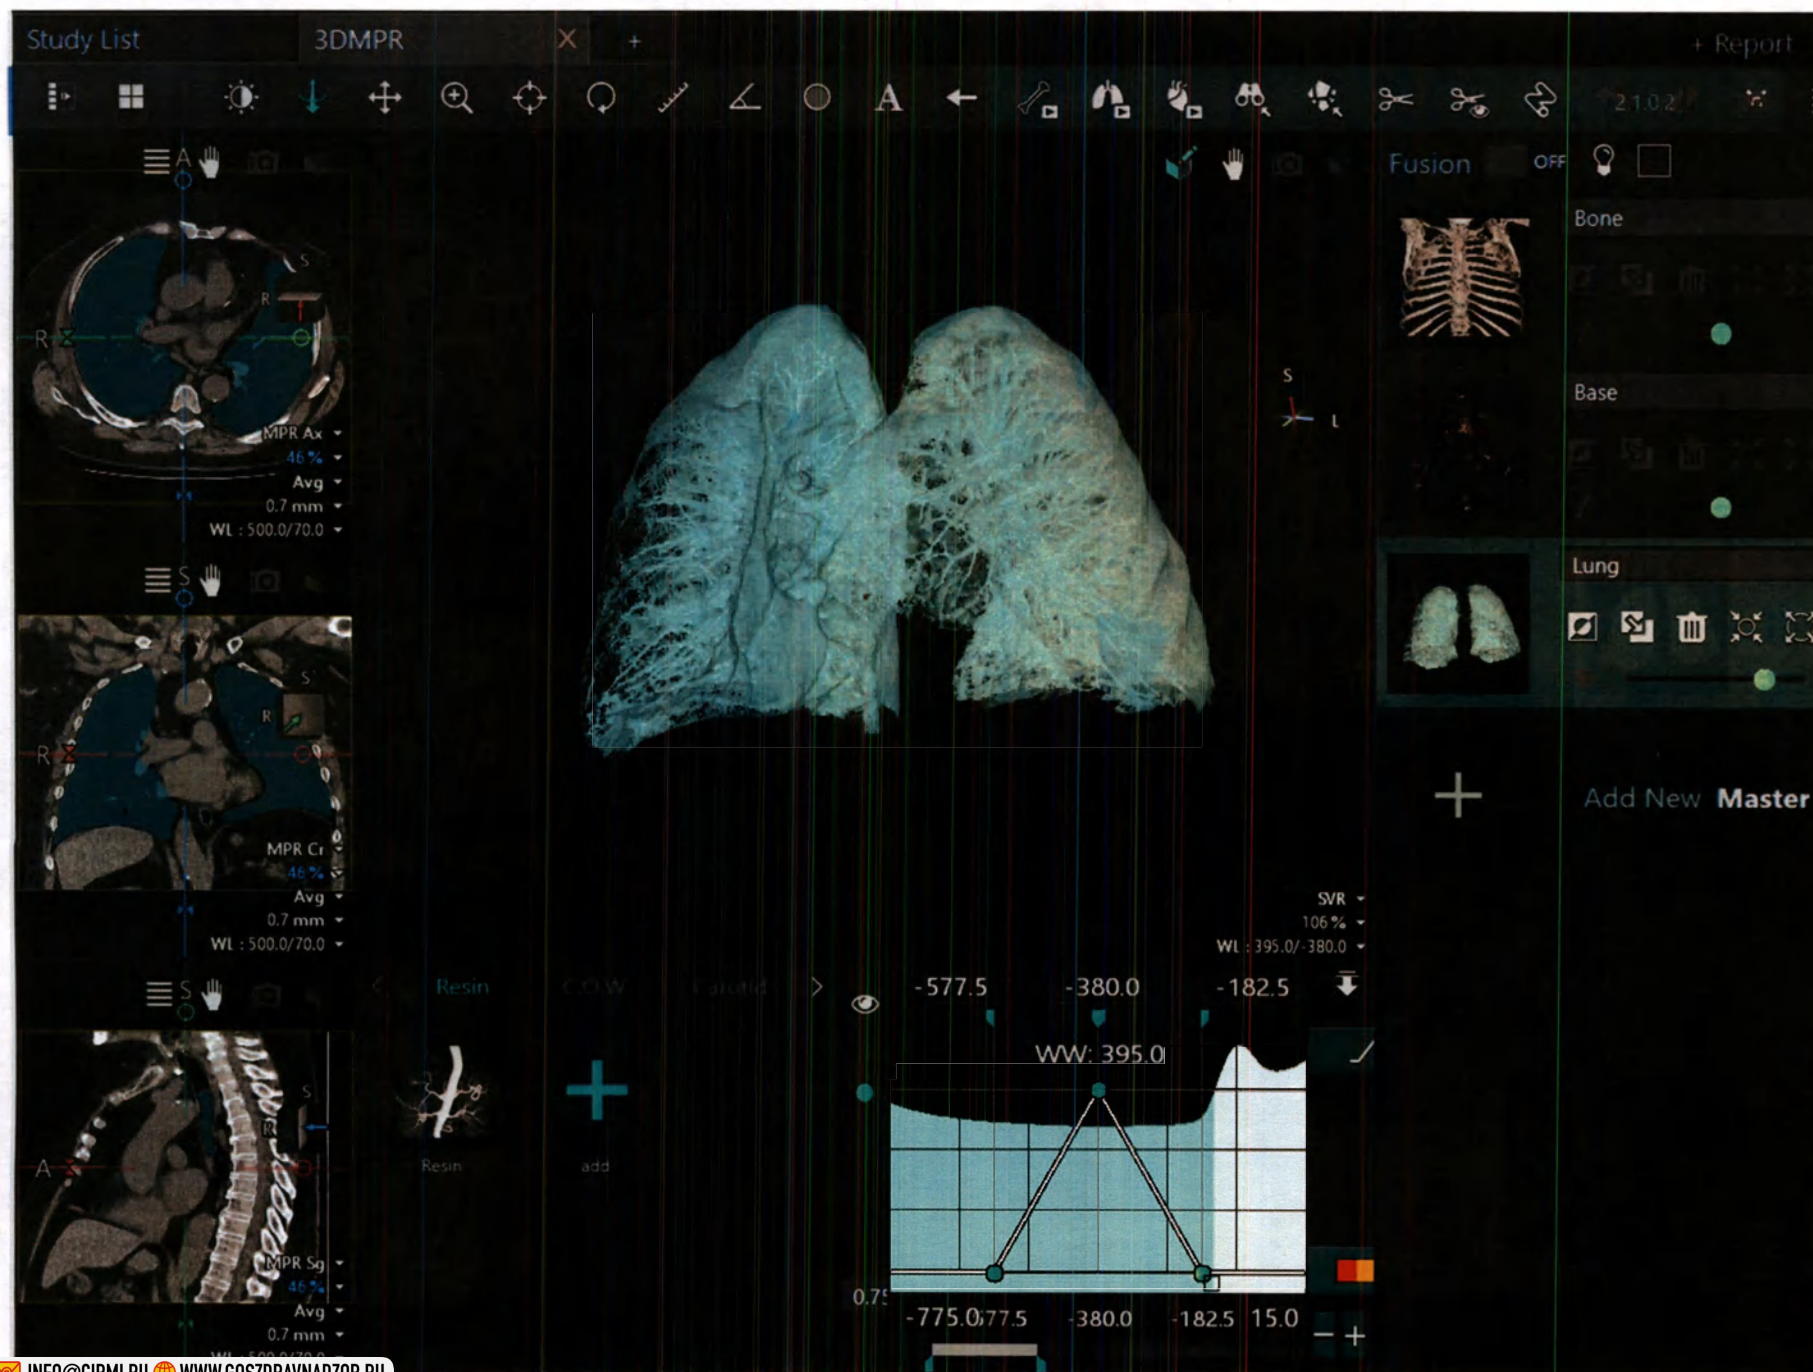


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.3 Приложение для совмещения КТ и ПЭТ/КТ изображений

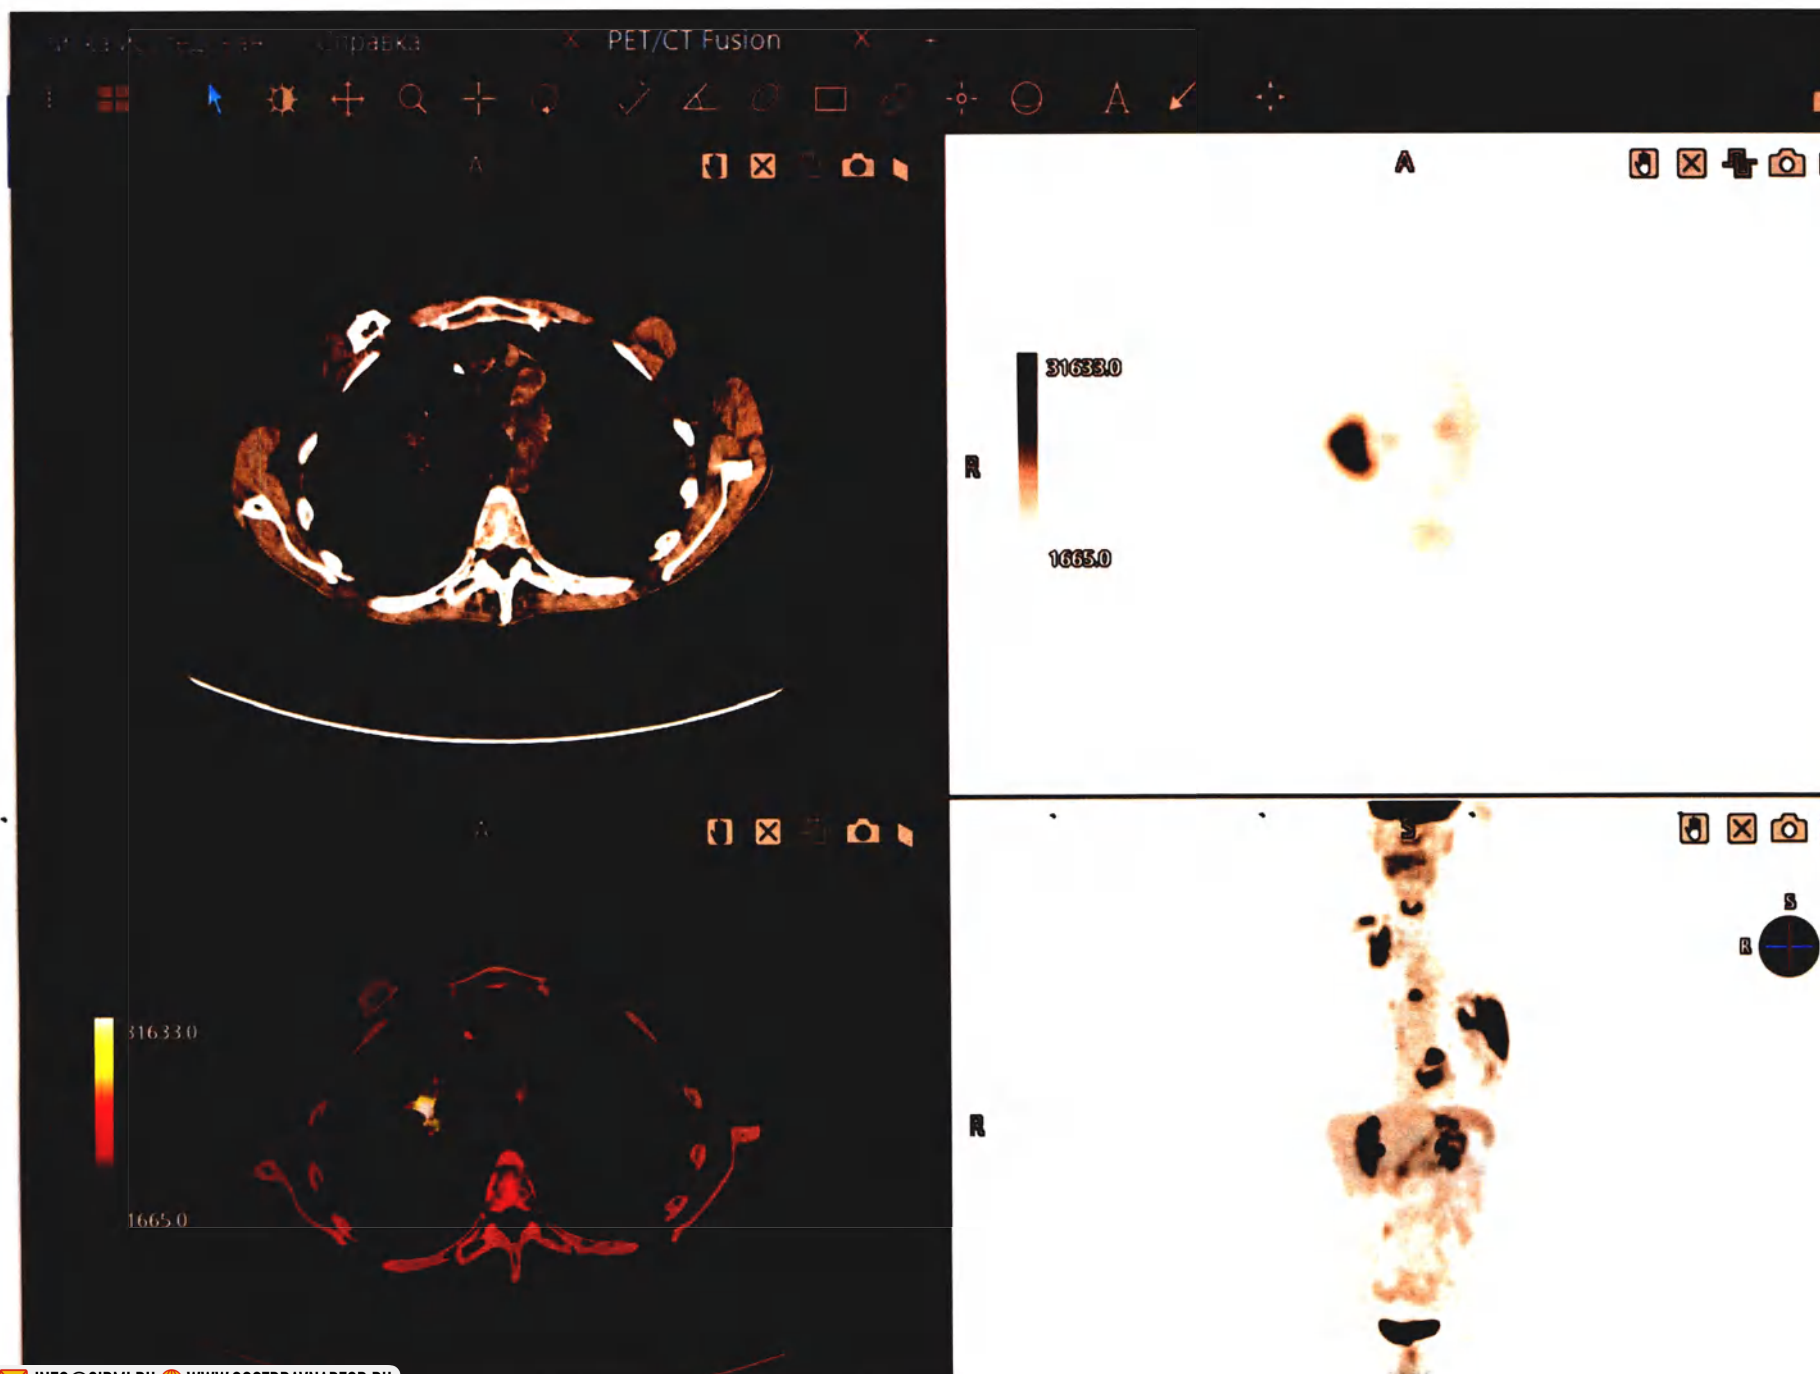

1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.4 Приложение для КТ-анализа сонных артерий

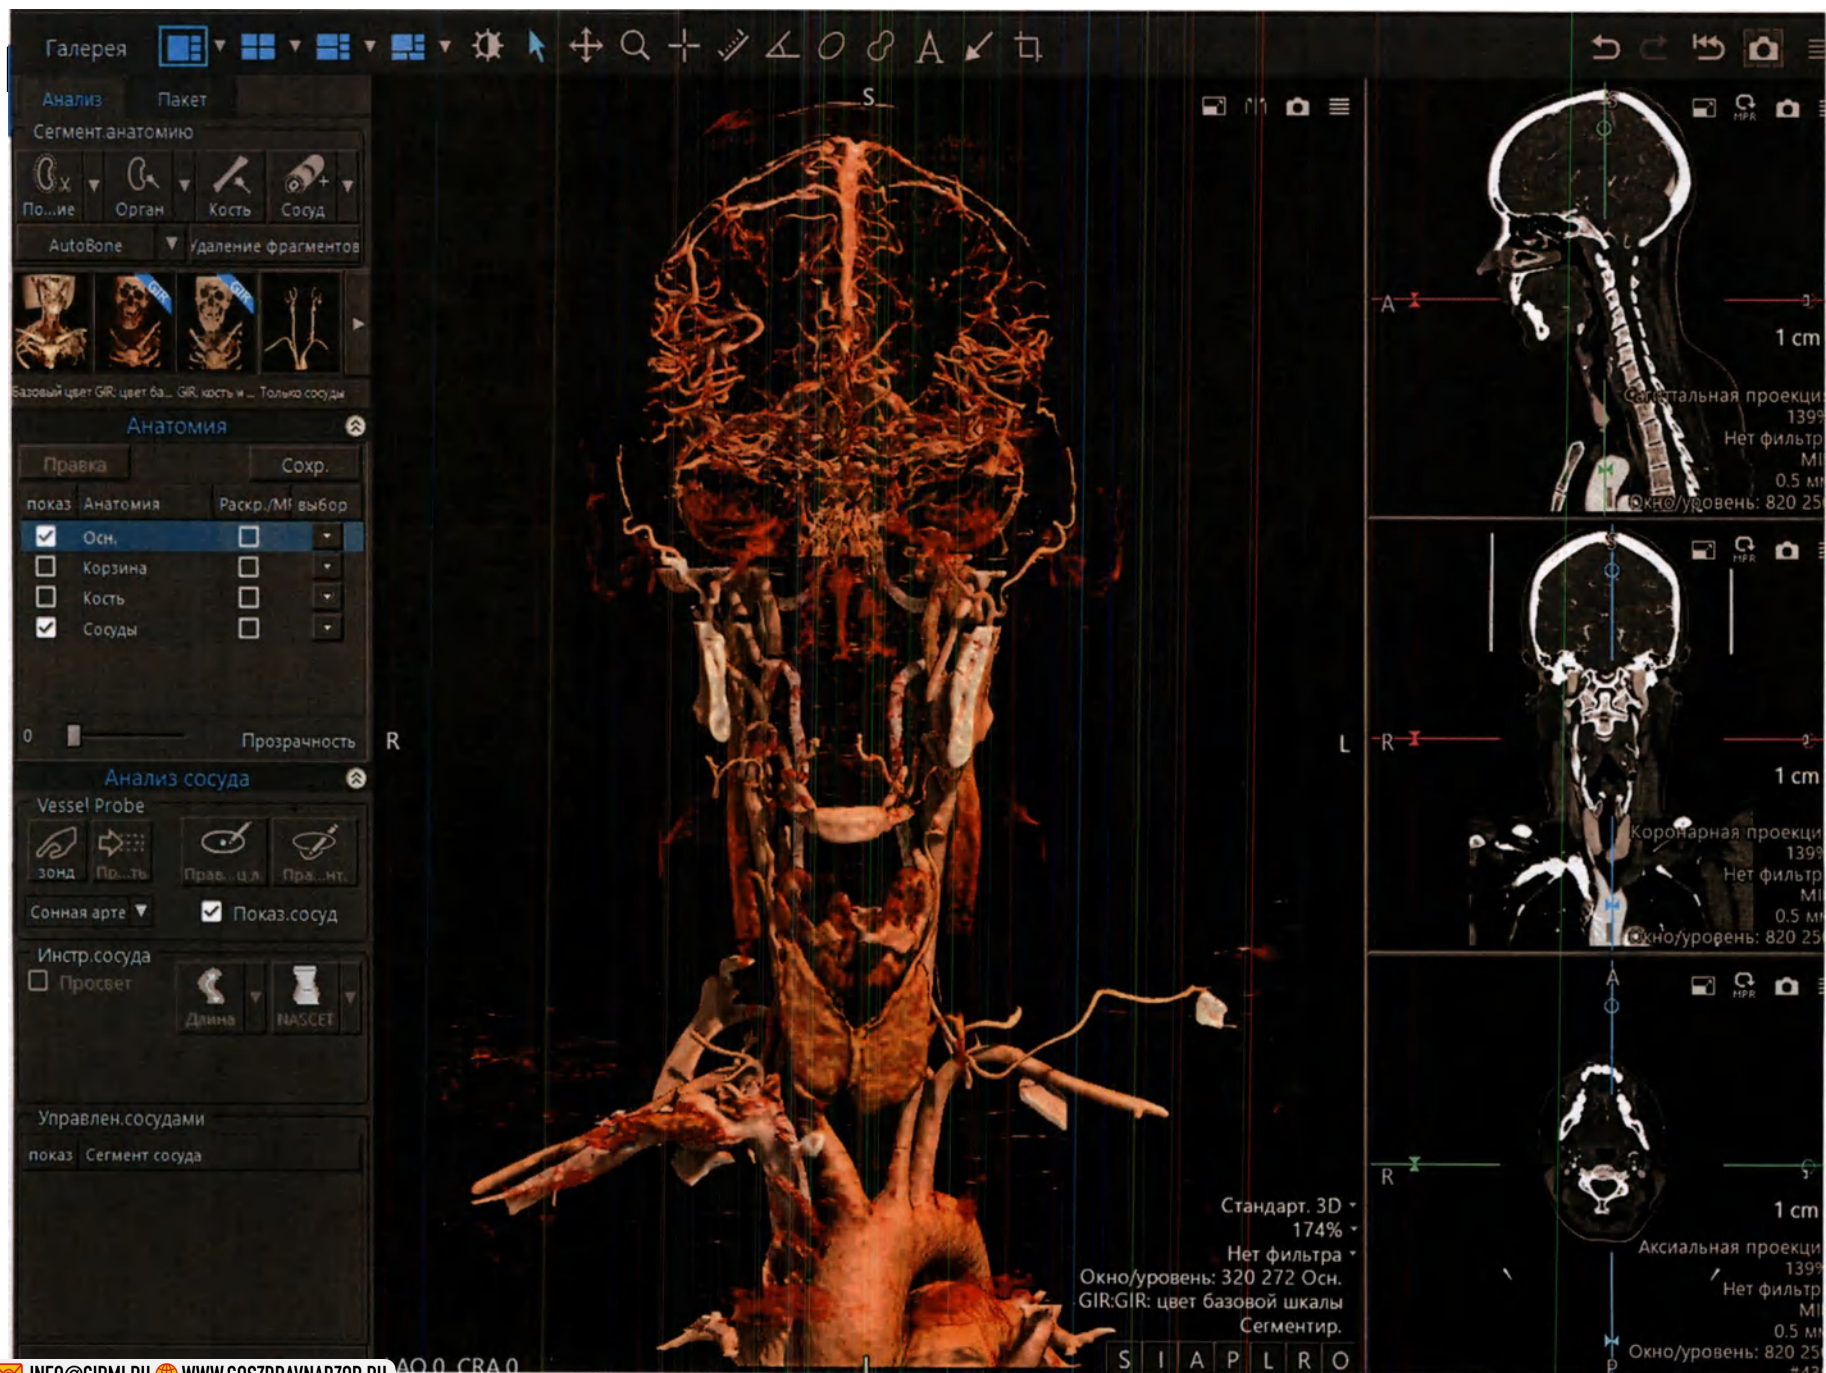


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

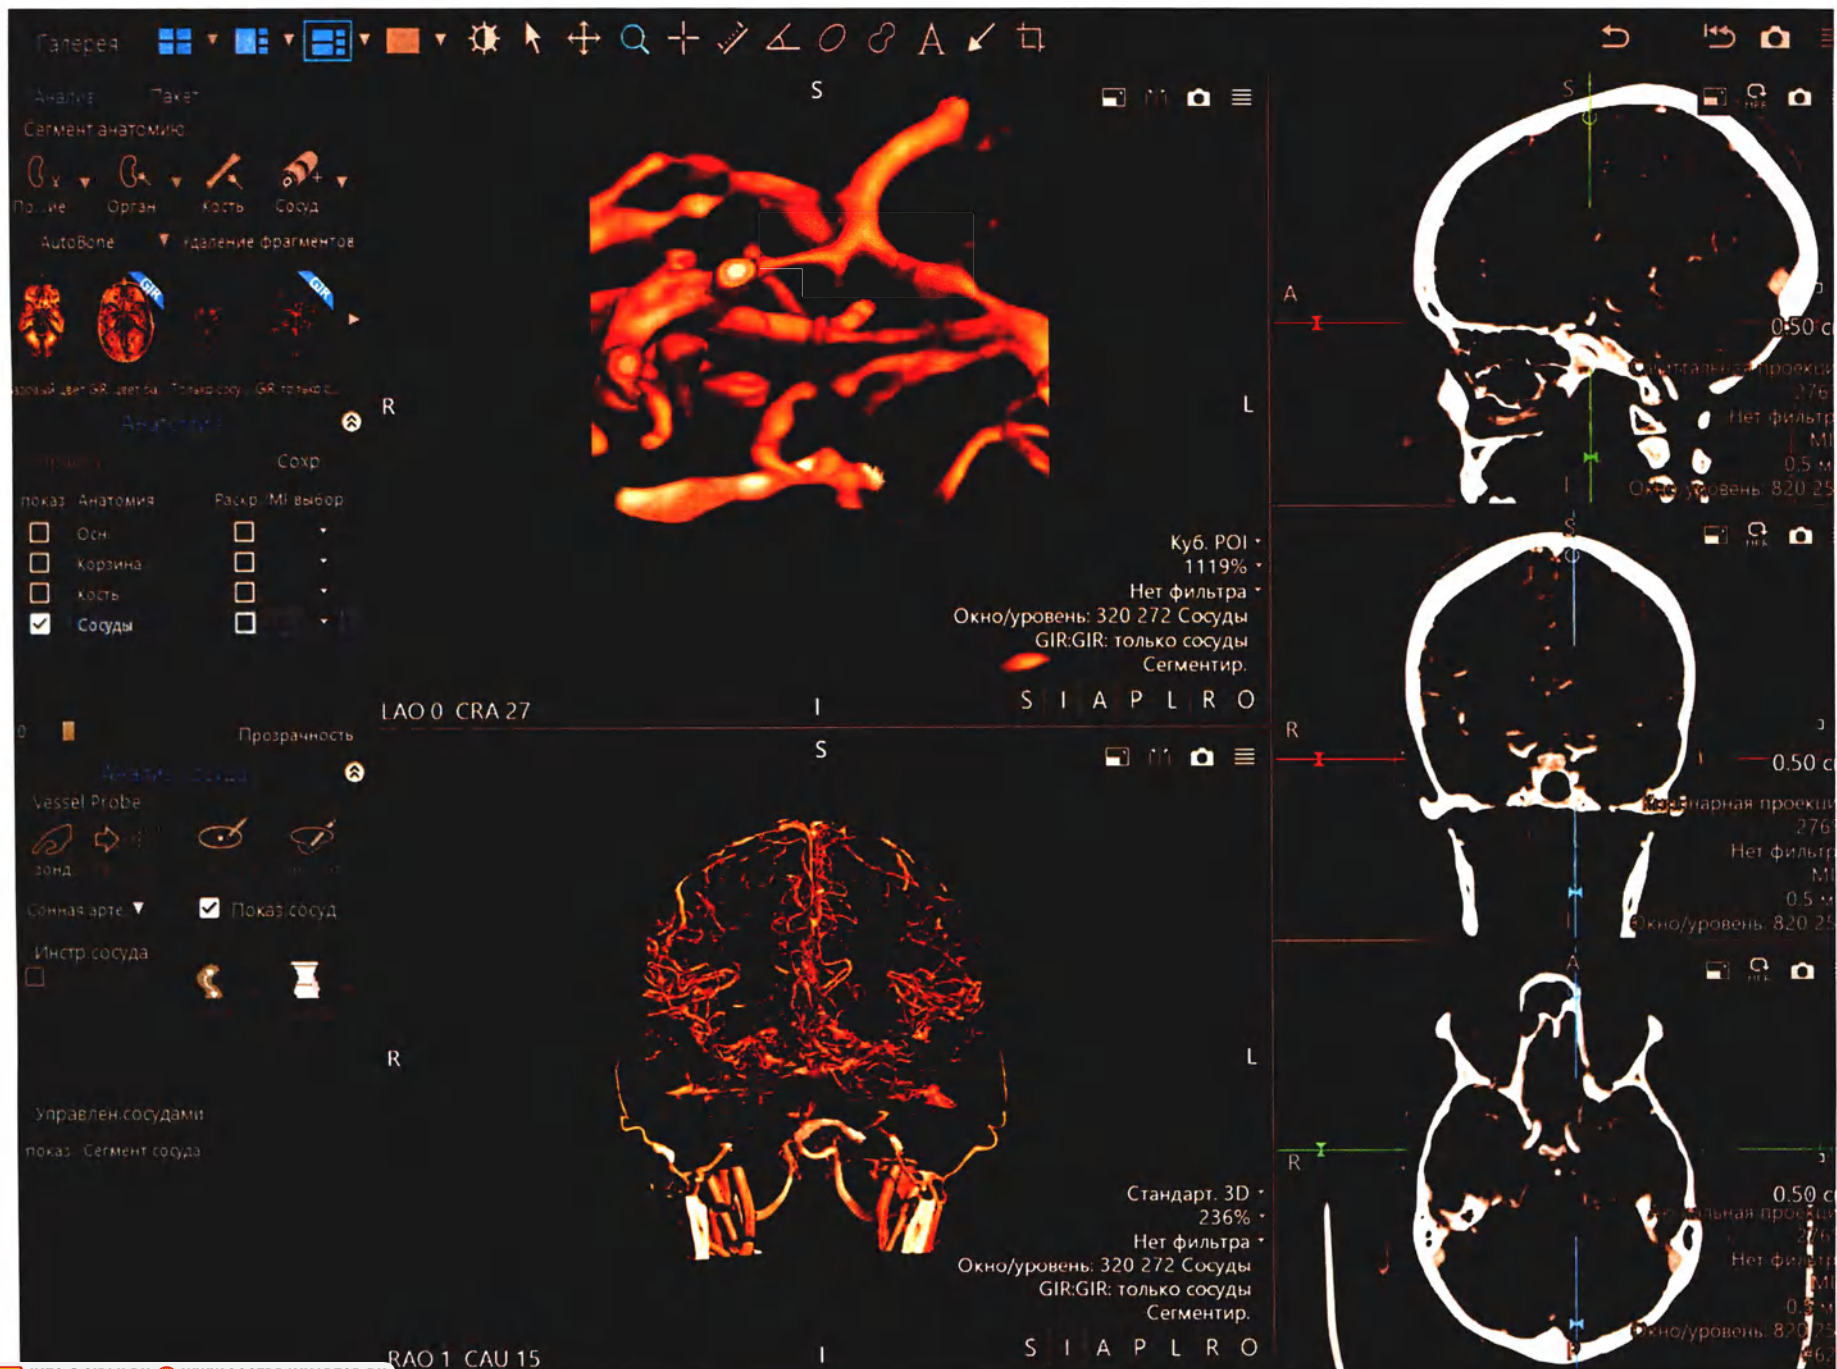


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.6 Приложение для КТ-анализа аорты




1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.7 Приложение для КТ-анализа артерий конечностей

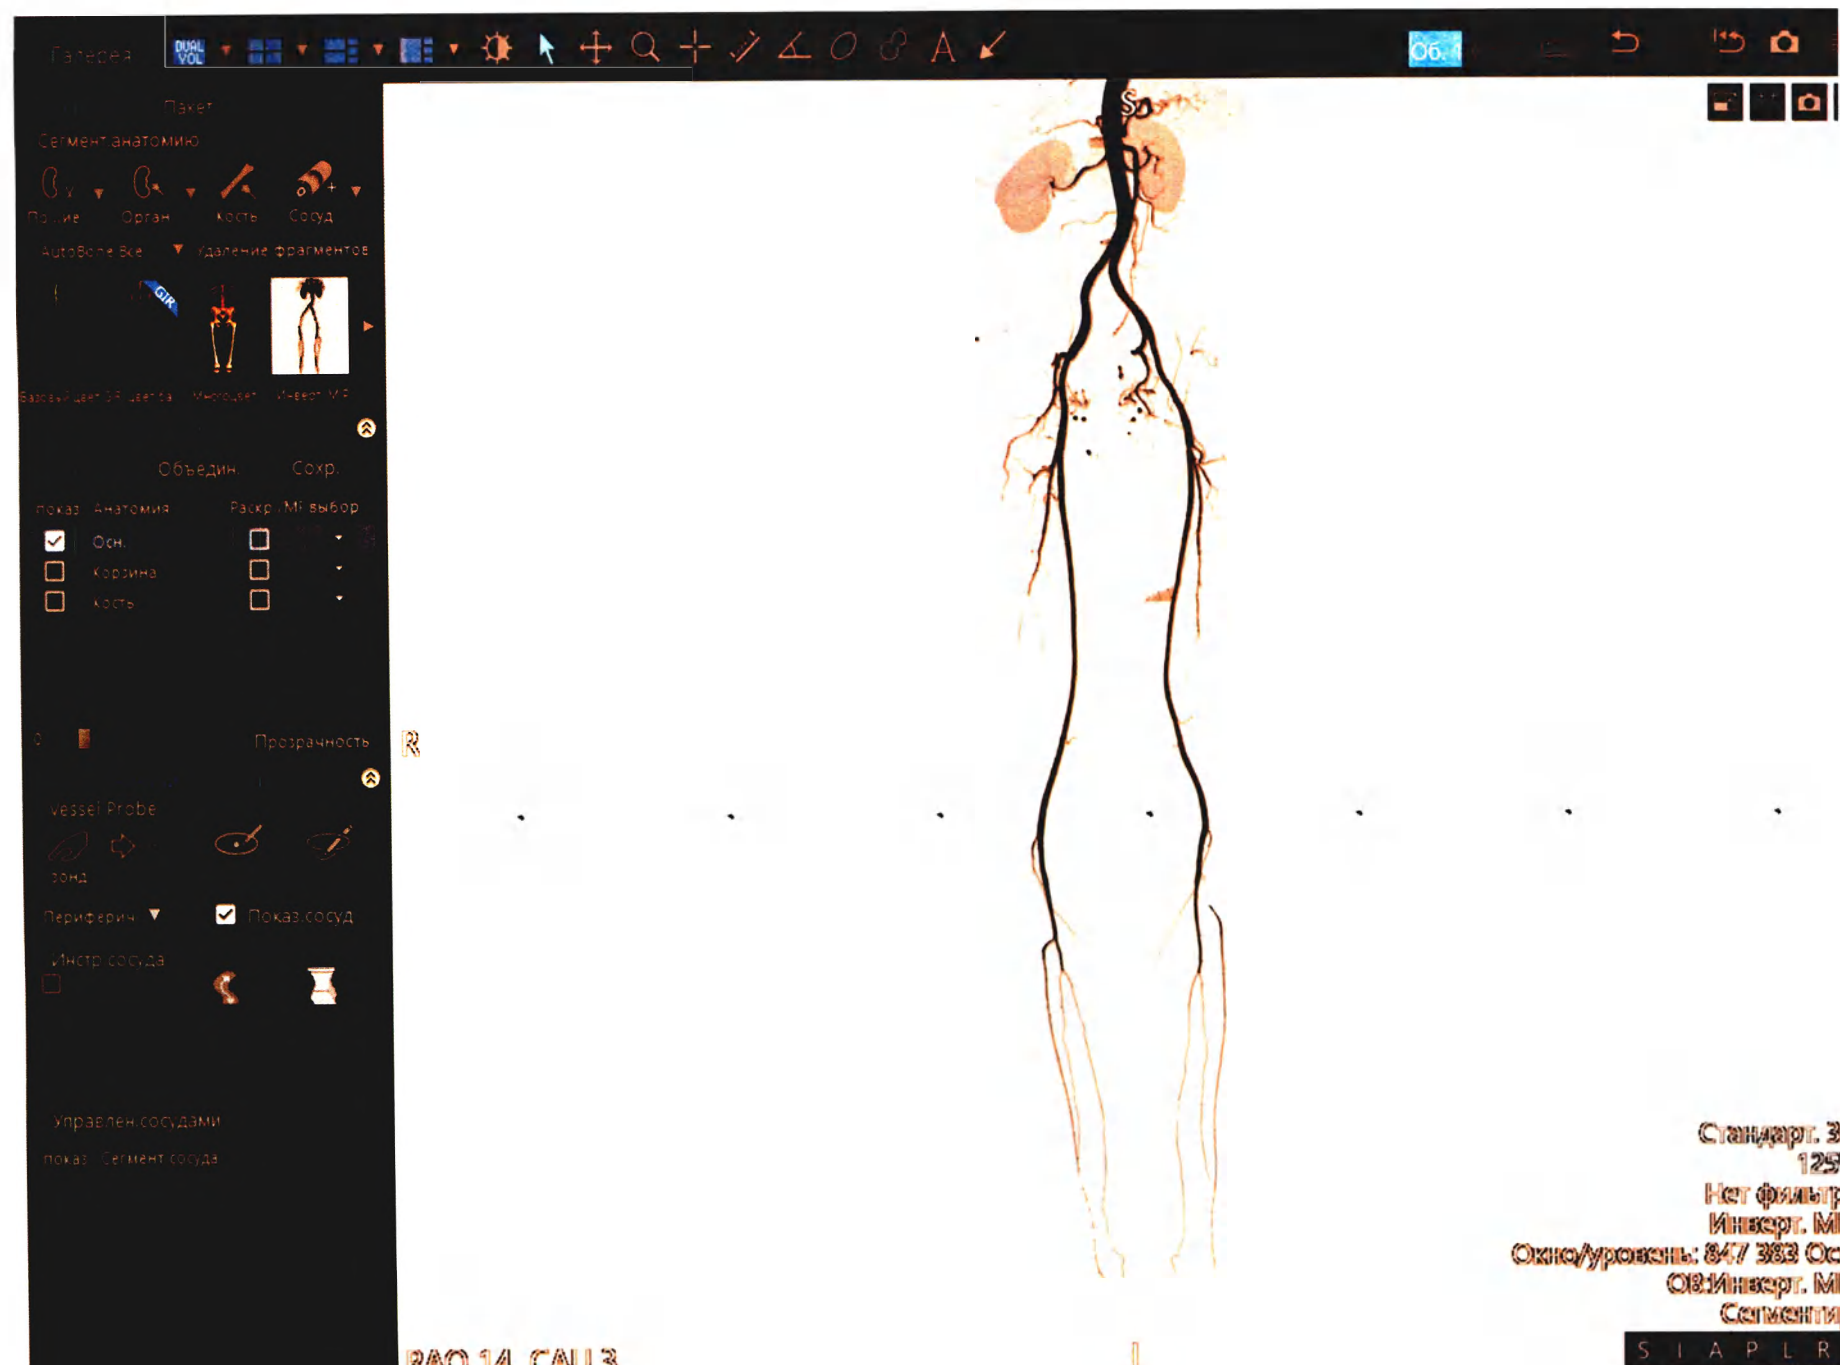

1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.8 Приложение для КТ-анализа почечных артерий

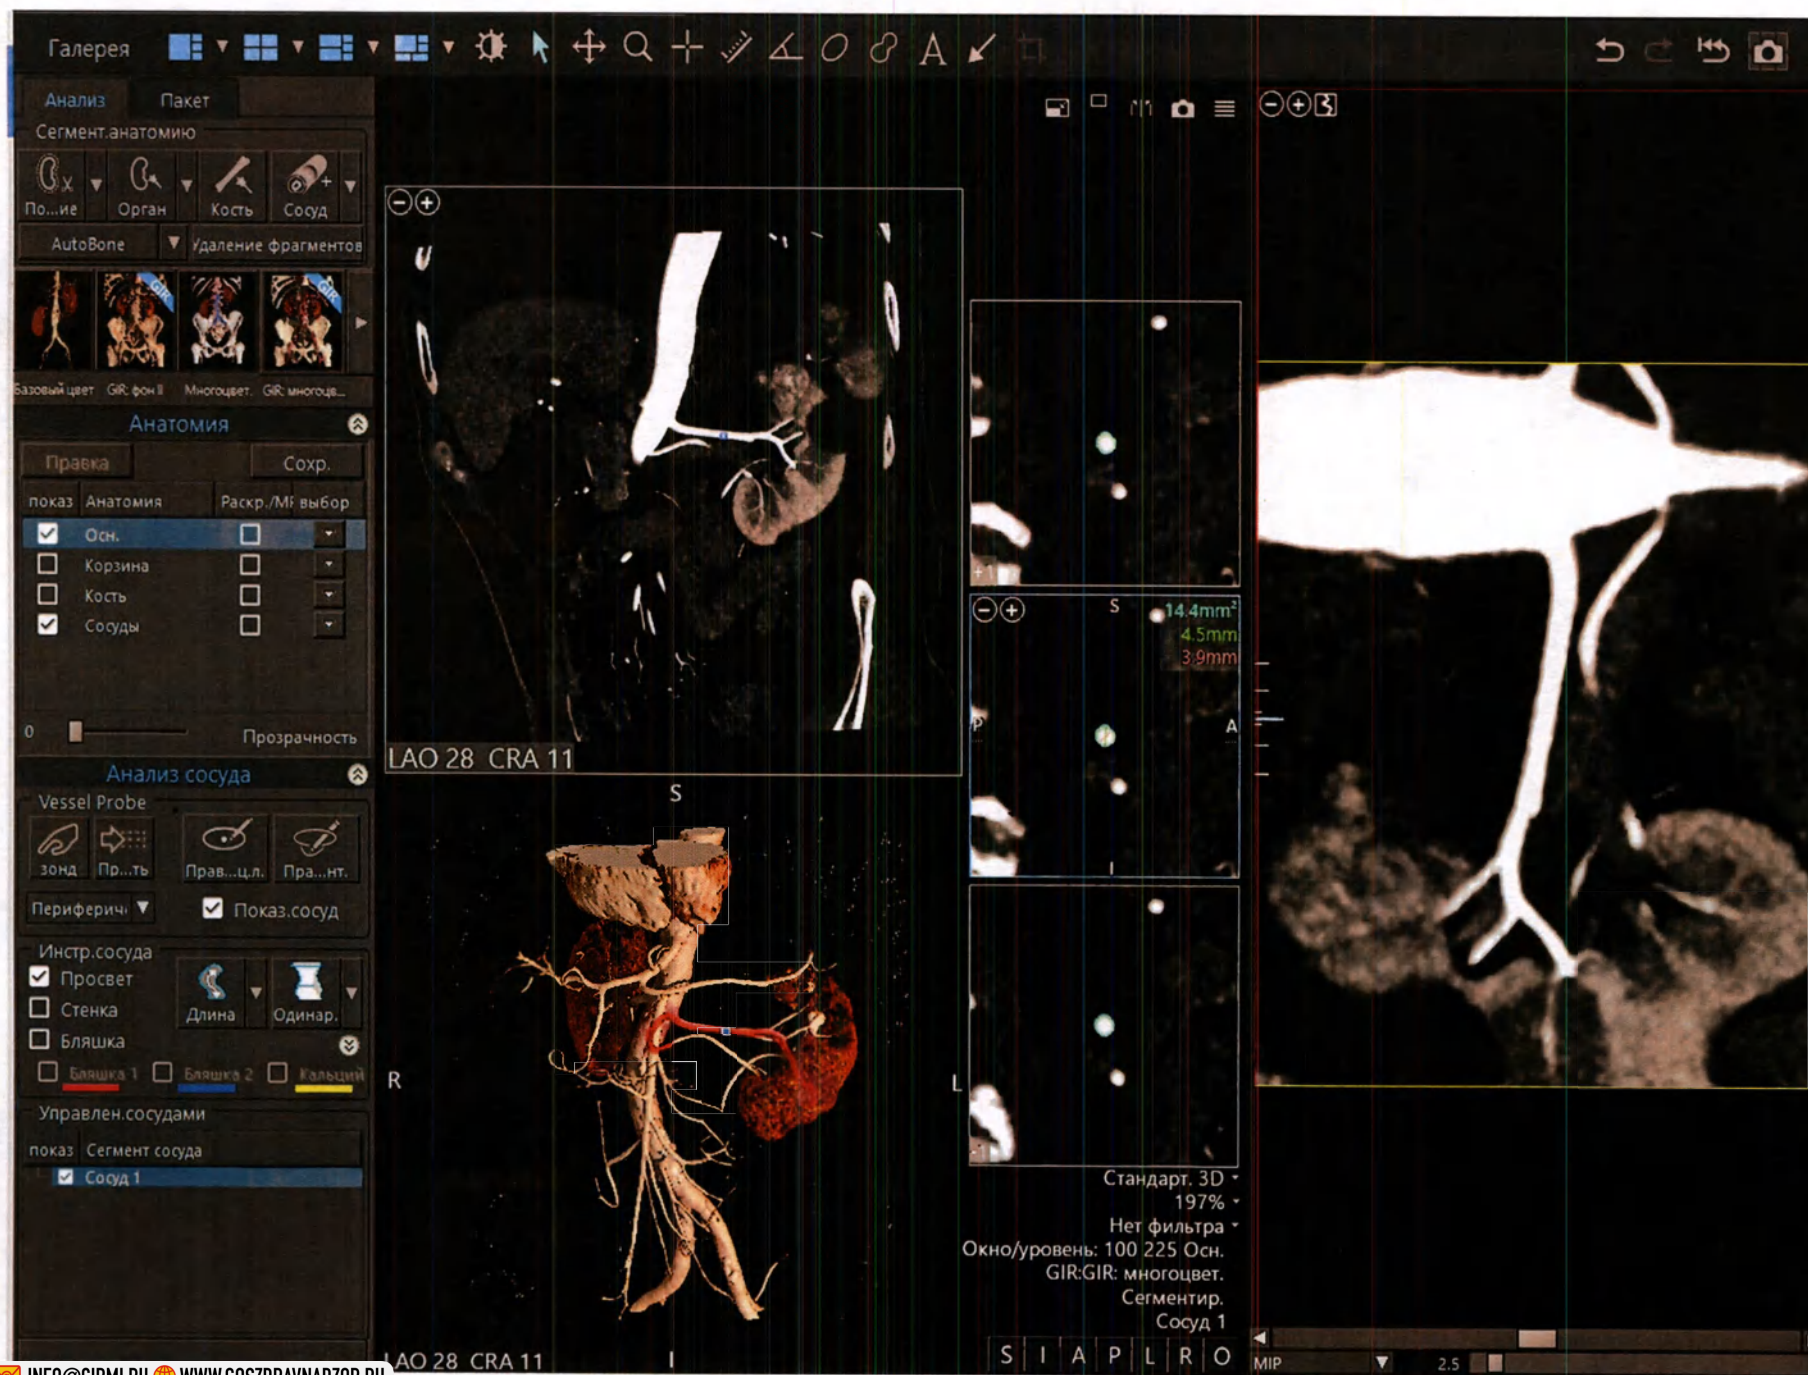


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.9 Приложение для КТ- урографии

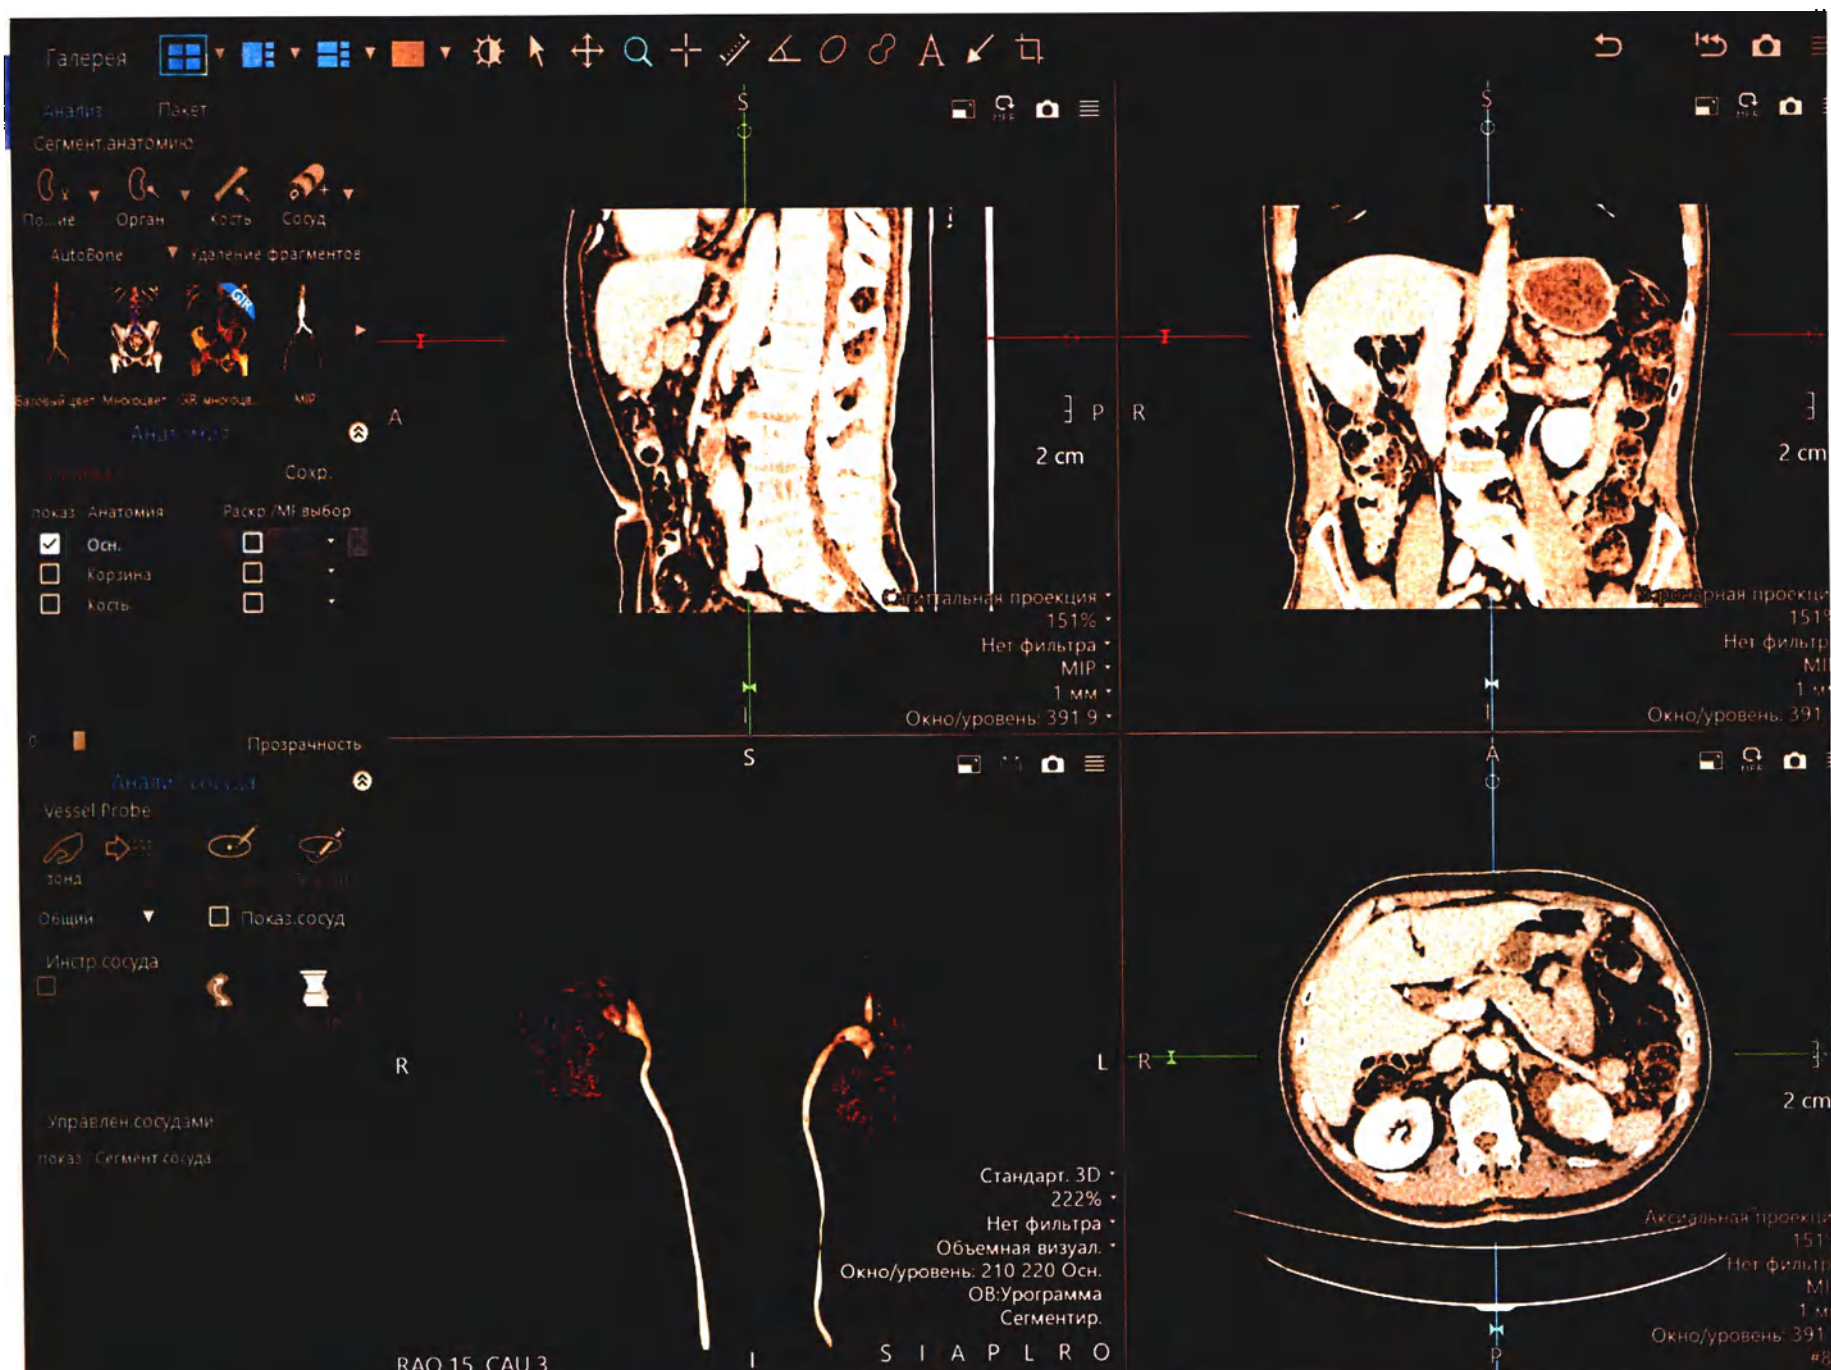


1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.10 Приложение для КТ-анализа костно-мышечной системы




1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.11 Приложение для МР-анализа опухолей головного мозга)

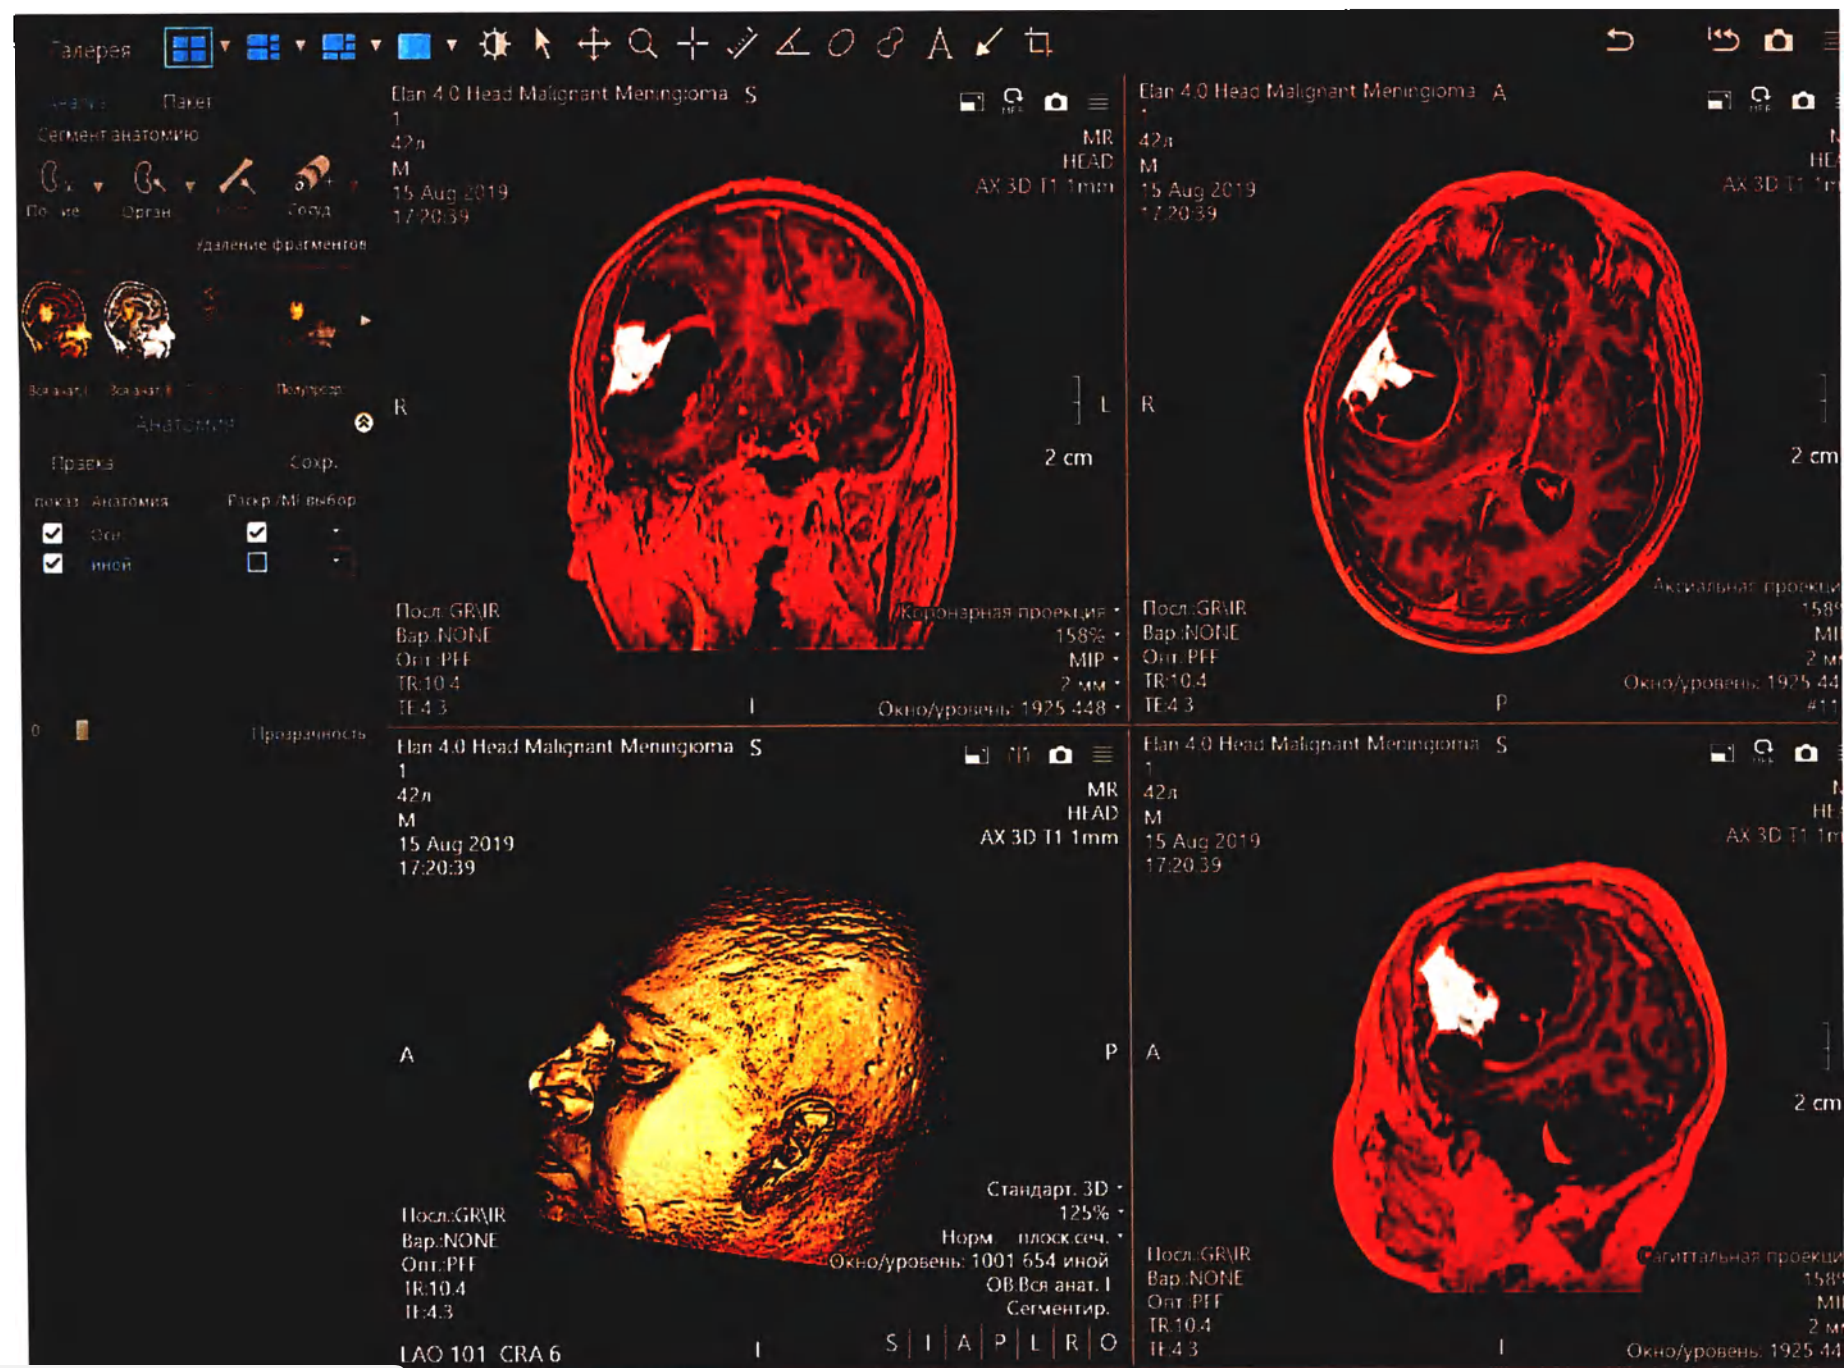

1.1 Программное обеспечение базовое, в составе: 1.1.12 Приложение для МР-анализа периферических сосудов

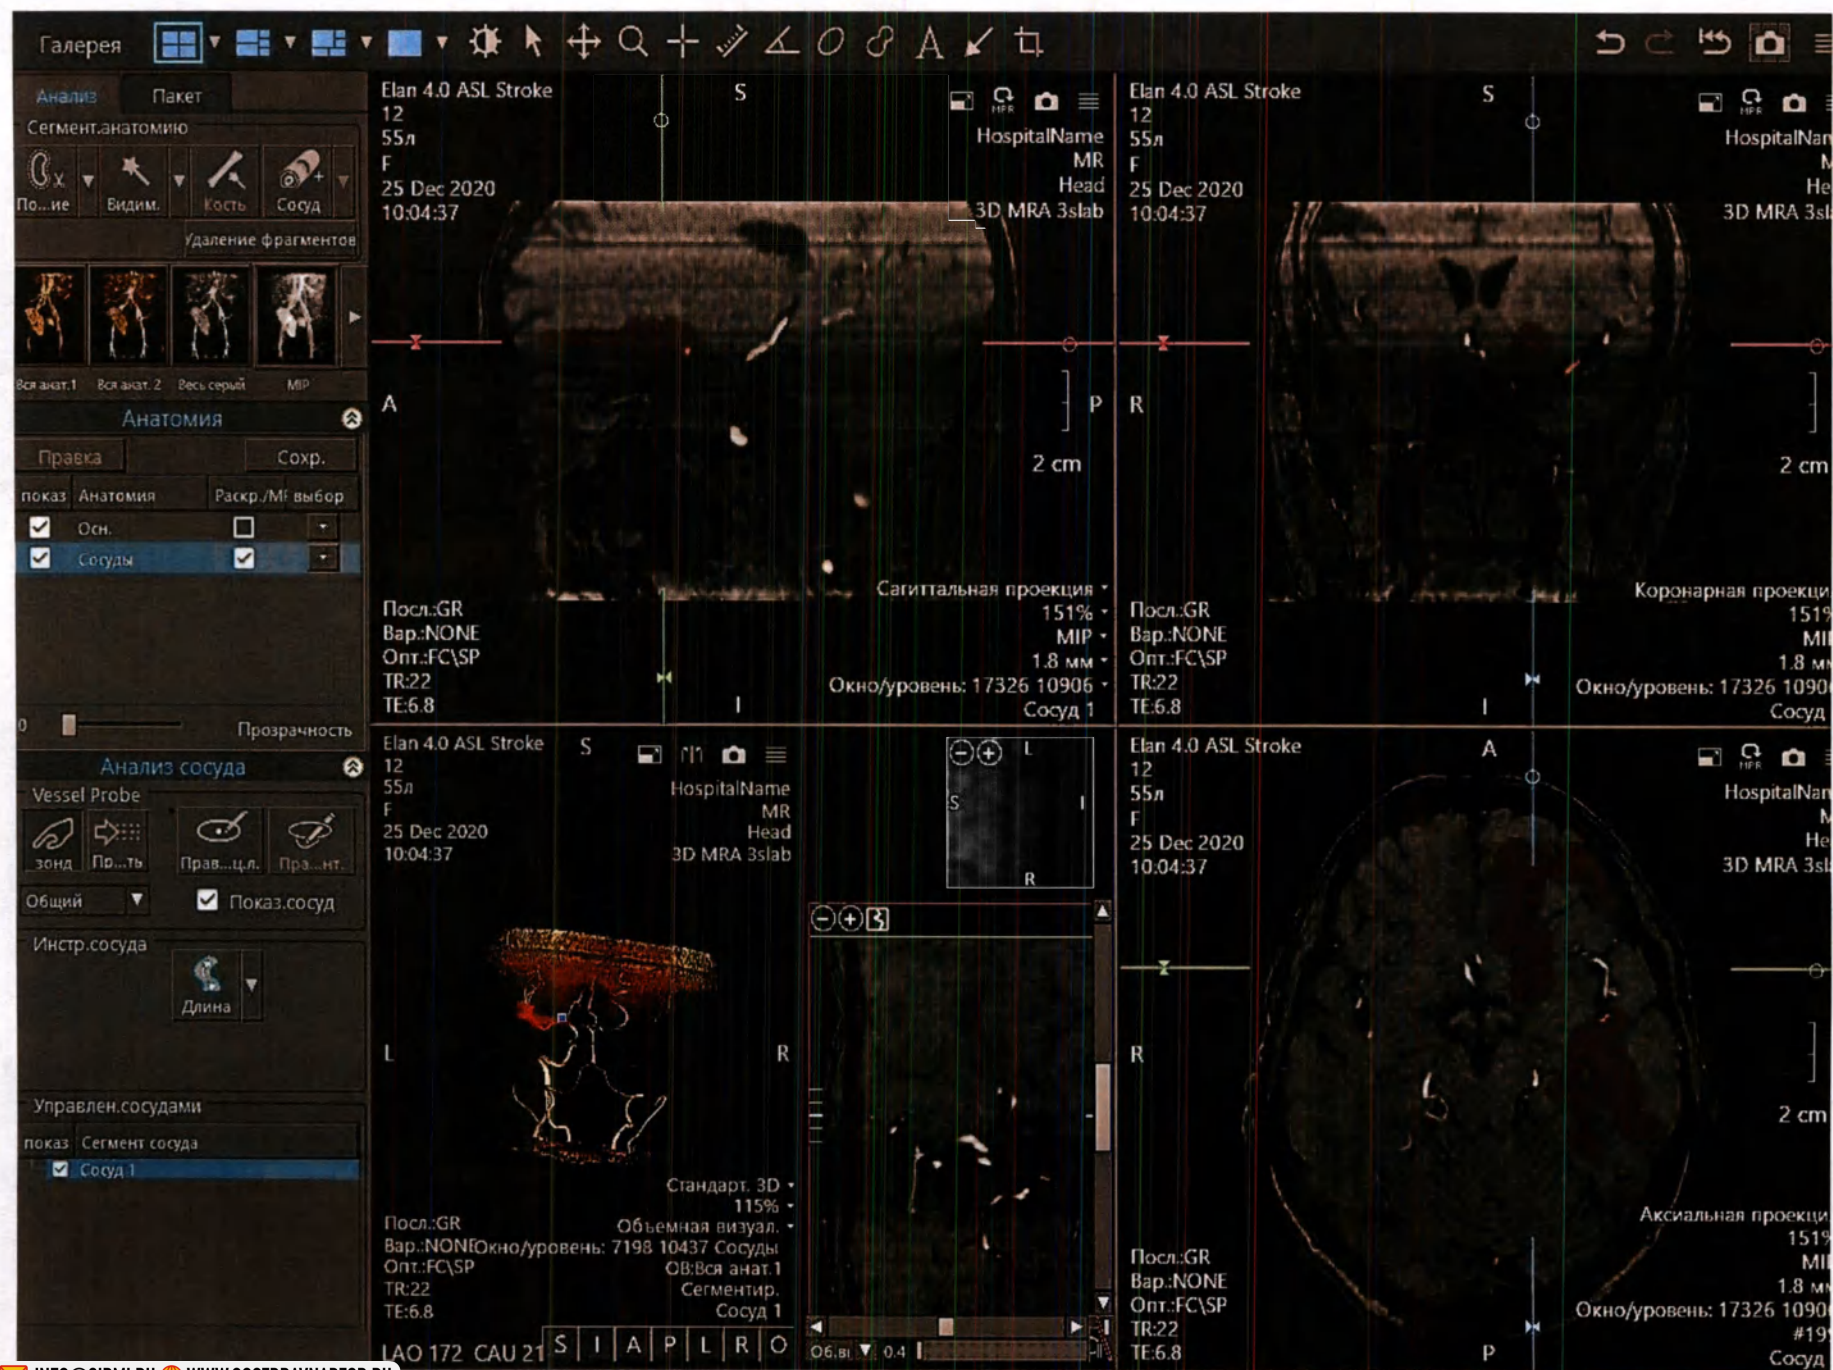

1.2 Приложение для сшивки МР-изображений (при необходимости)

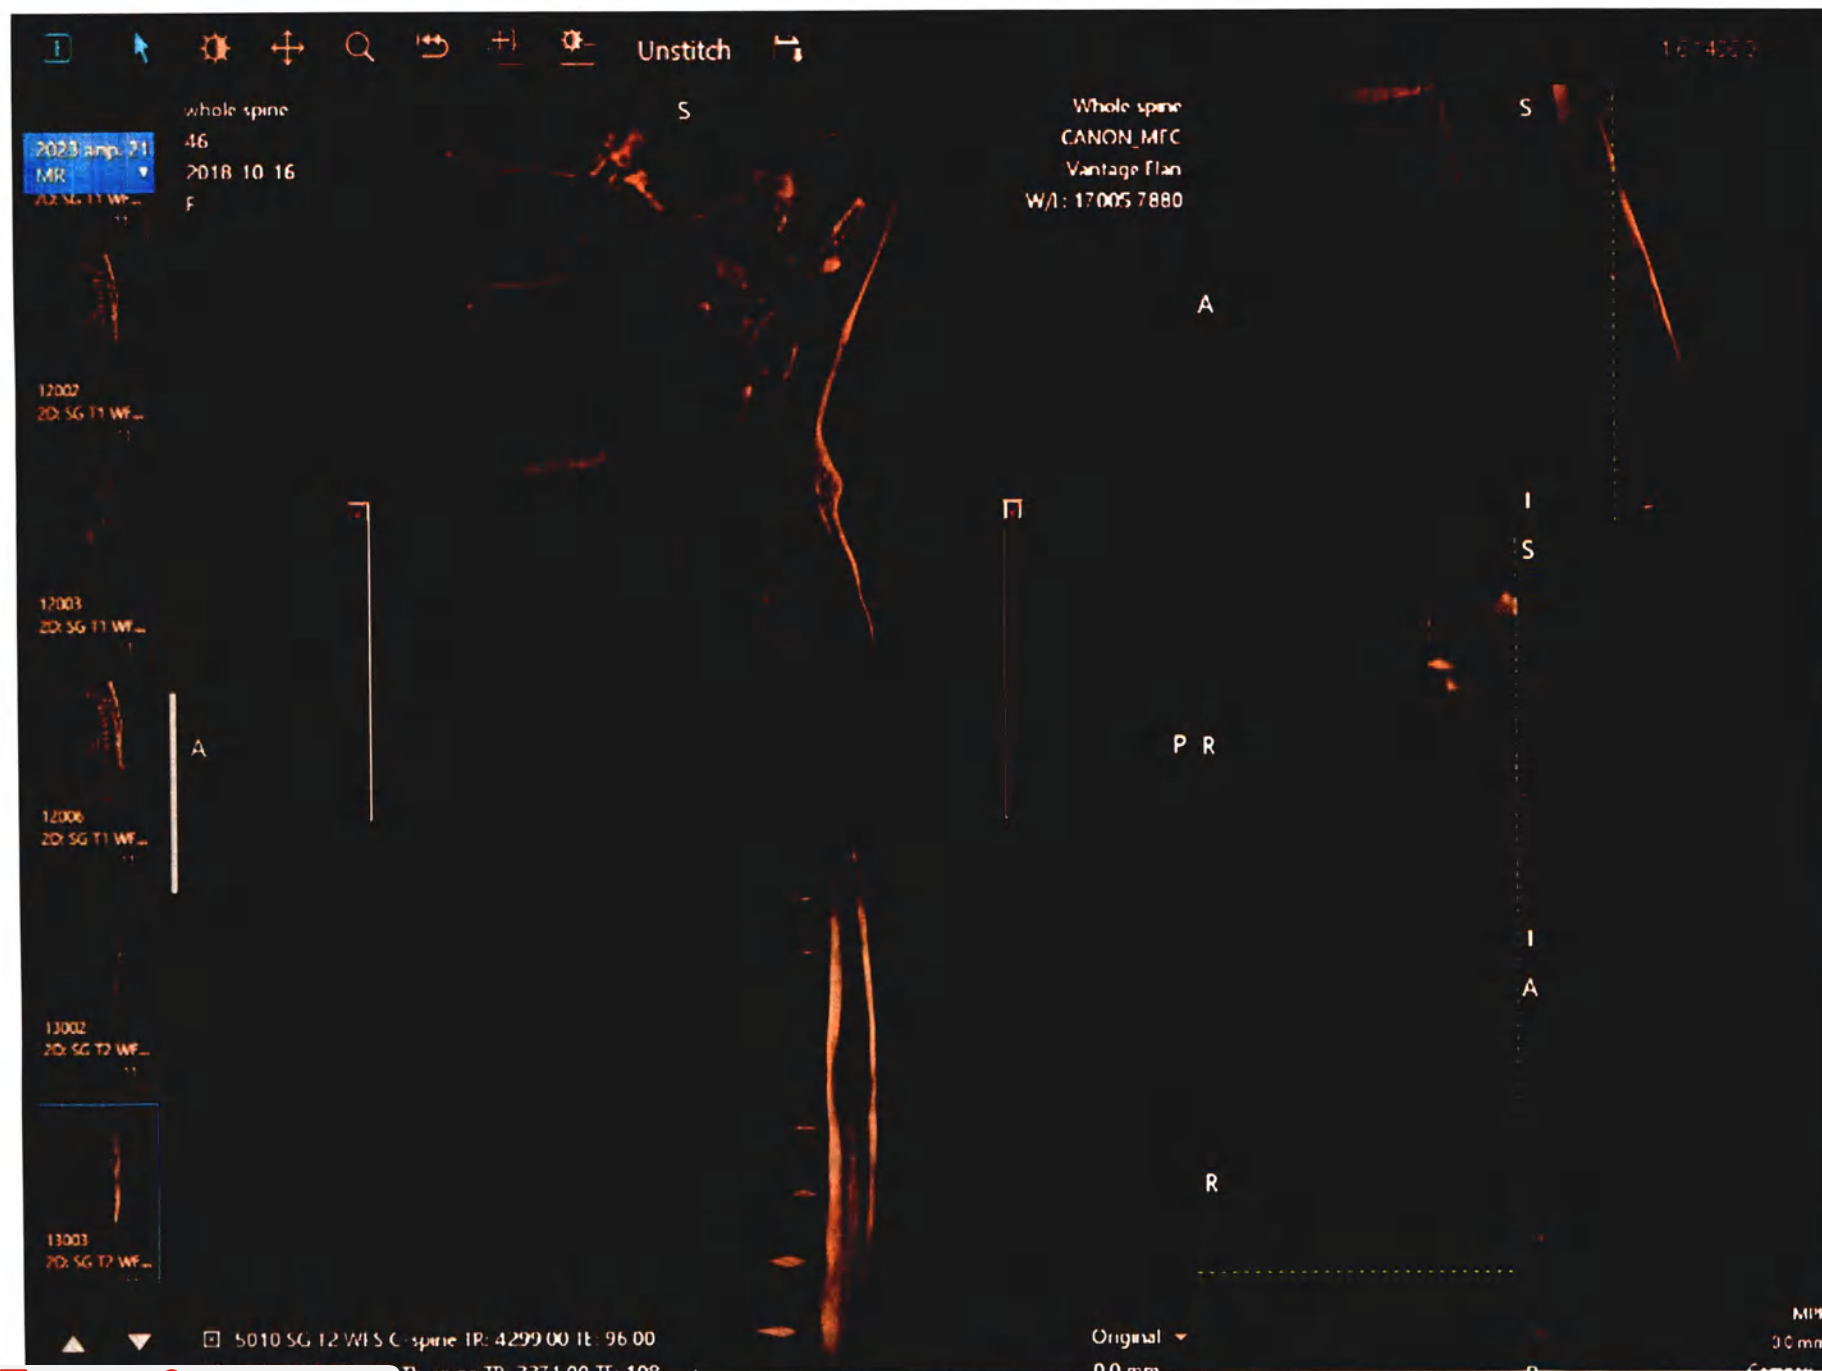


Vitreau® Advanced Visualization

Общее учебно-справочное руководство по
программному обеспечению Vitrea


Canon

VPMC-16620 C


3. Приложение для обработки данных последовательности серии контрастных изображений на рабочей станции (при необходимости)

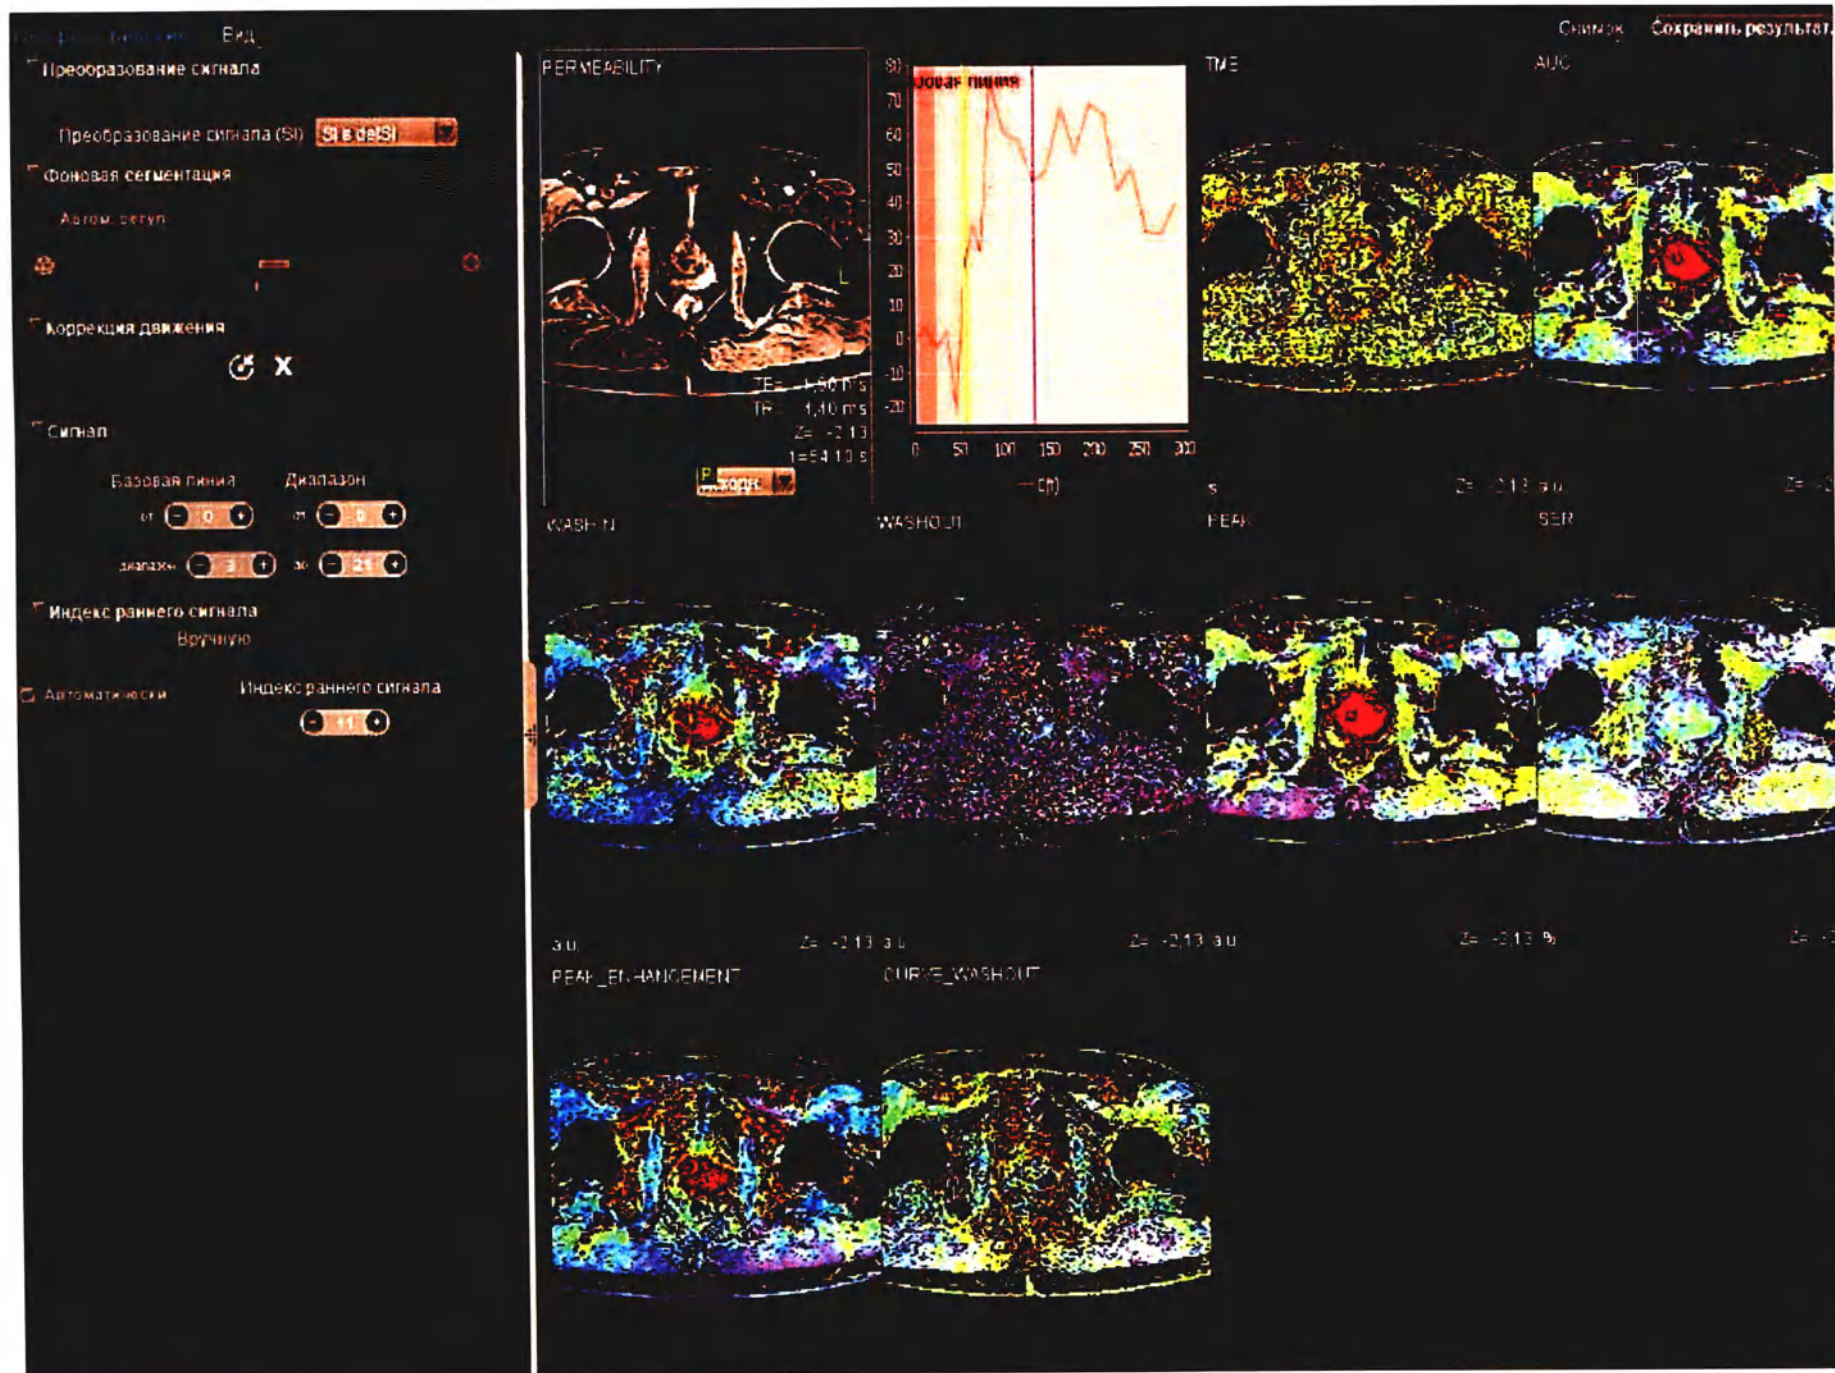


4. Программный пакет для характеристики тканей молочных желез и последующего наблюдения (при необходимости)

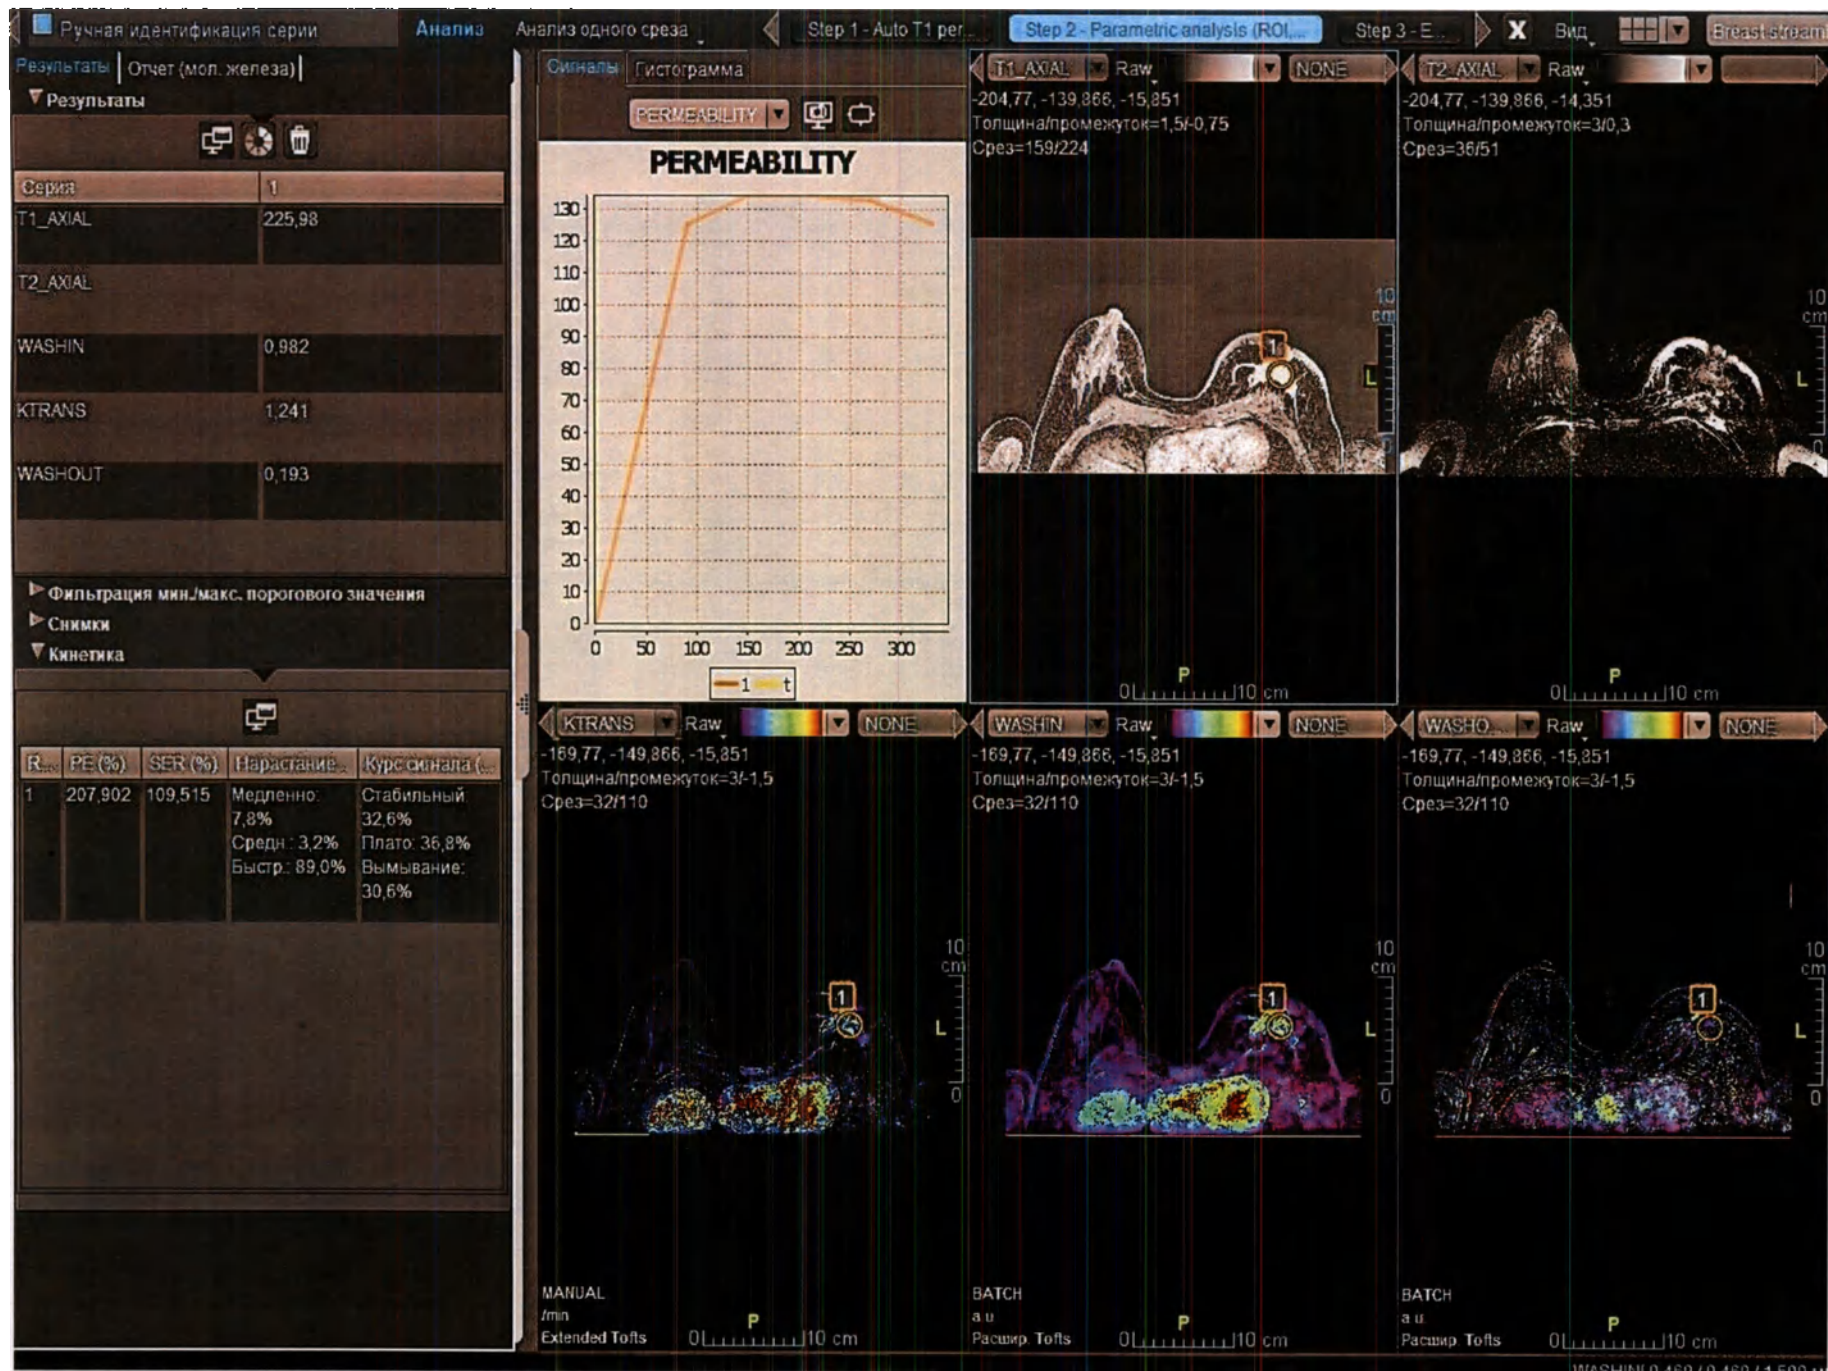


5. Программный пакет для планирования интервенций на молочных железах (при необходимости)

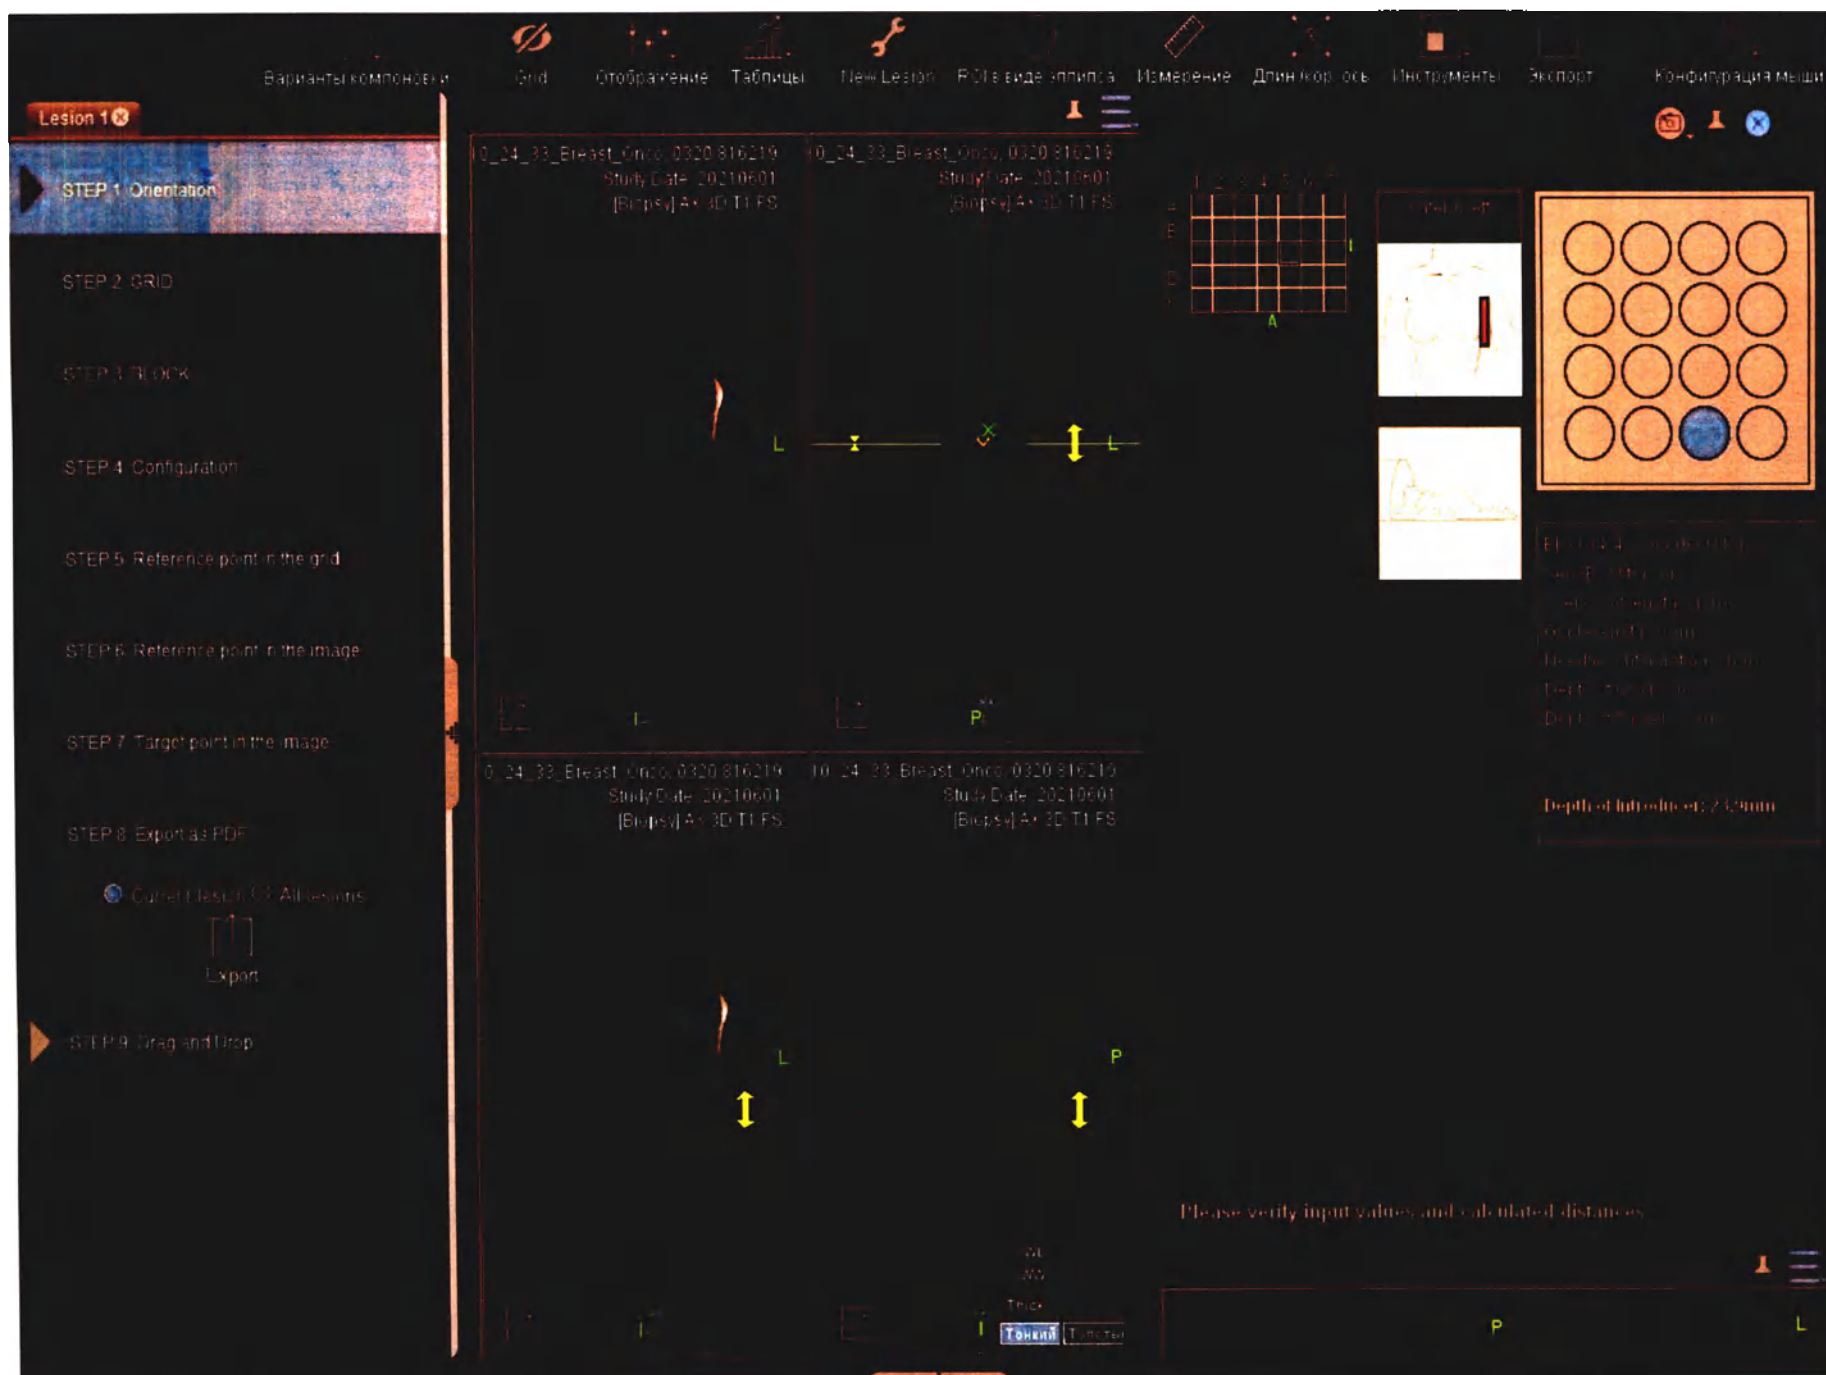


6. Приложение для визуализации потоков (при необходимости)

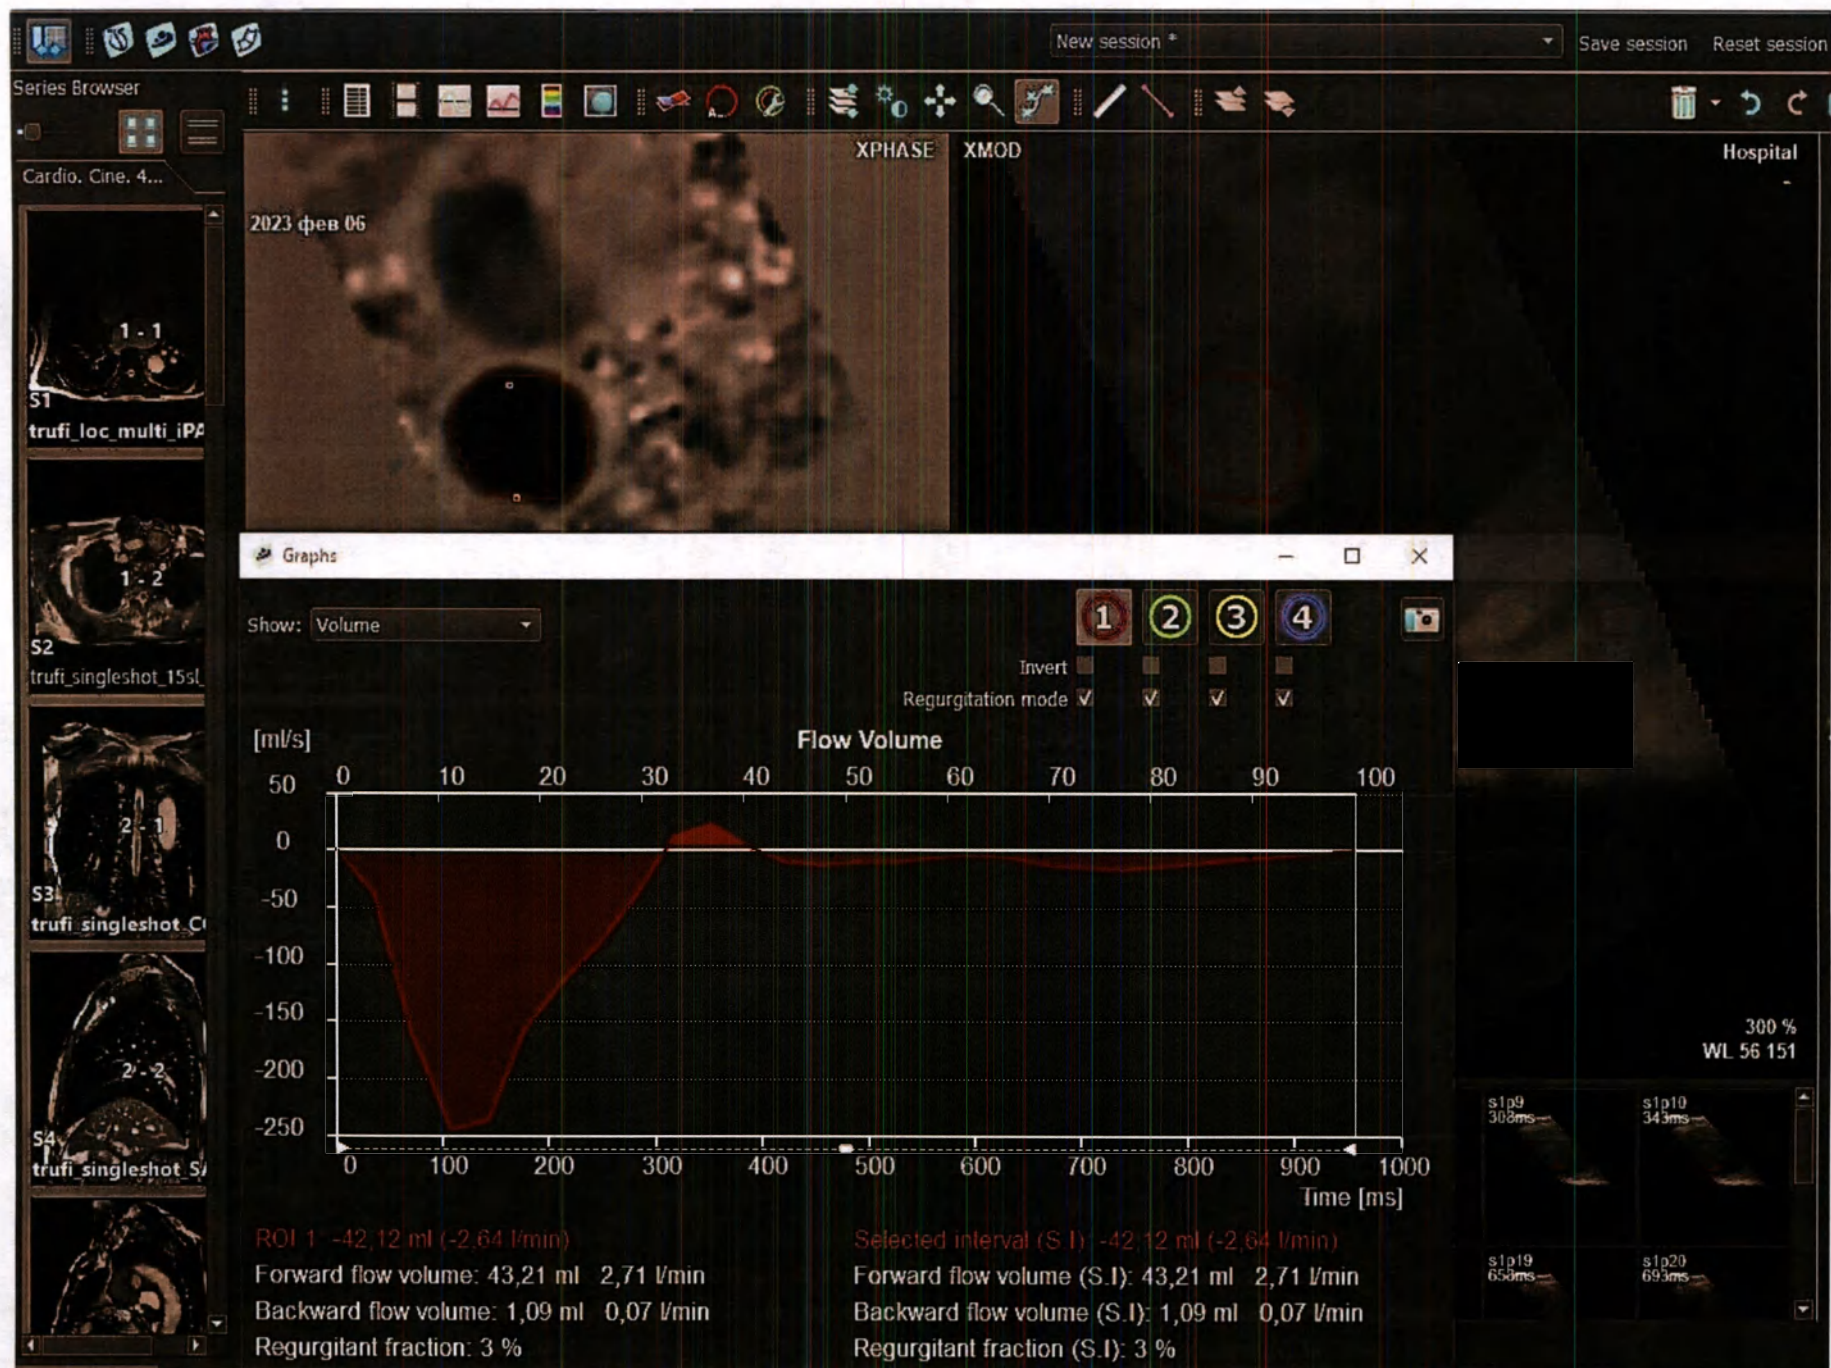


7. Приложение для анализа функции сократимости сердца (при необходимости)

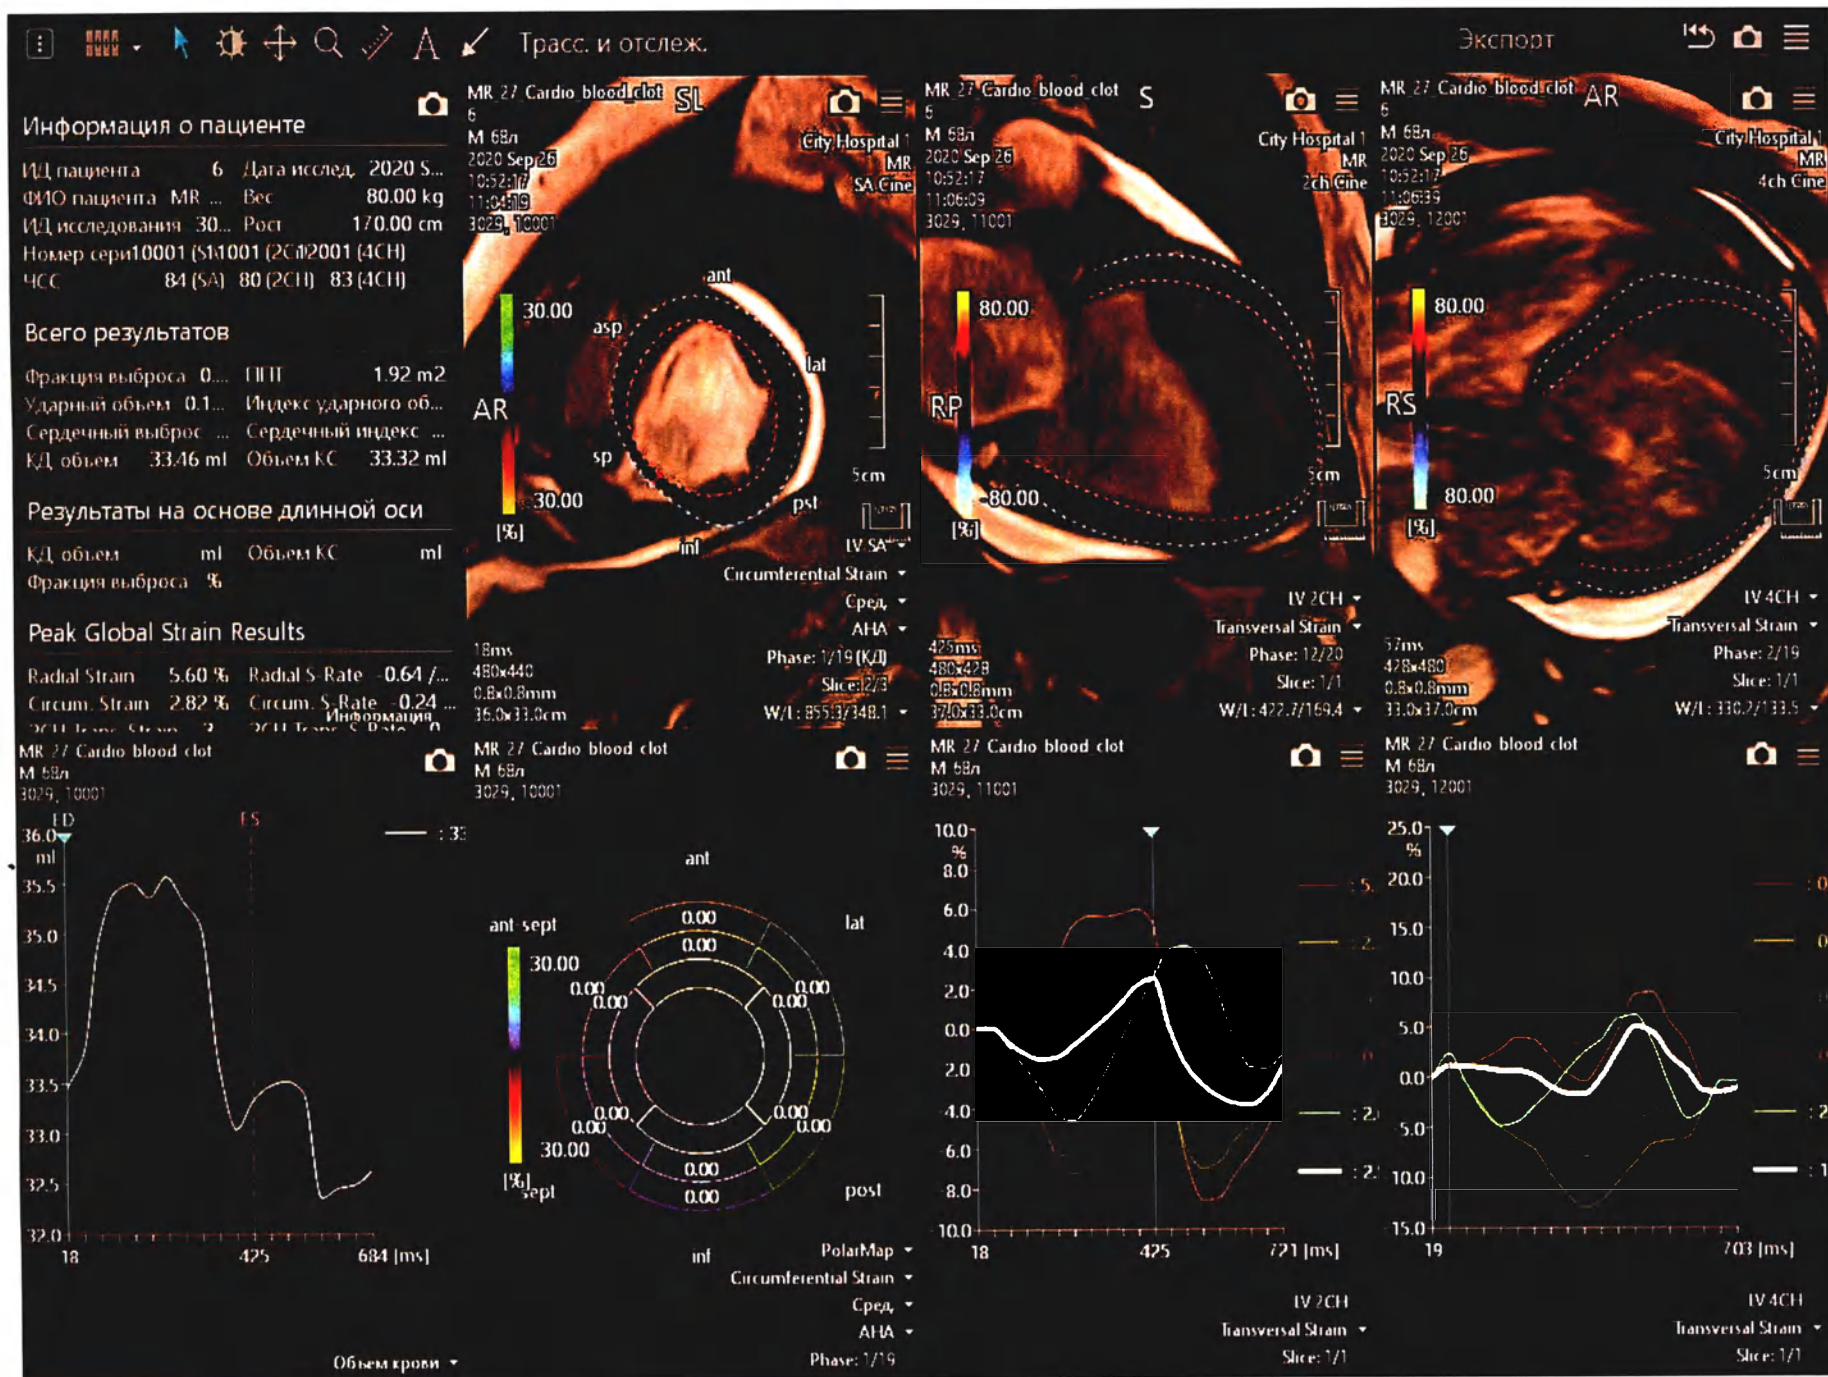


8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Diffusion Weighted Imaging (DWI))

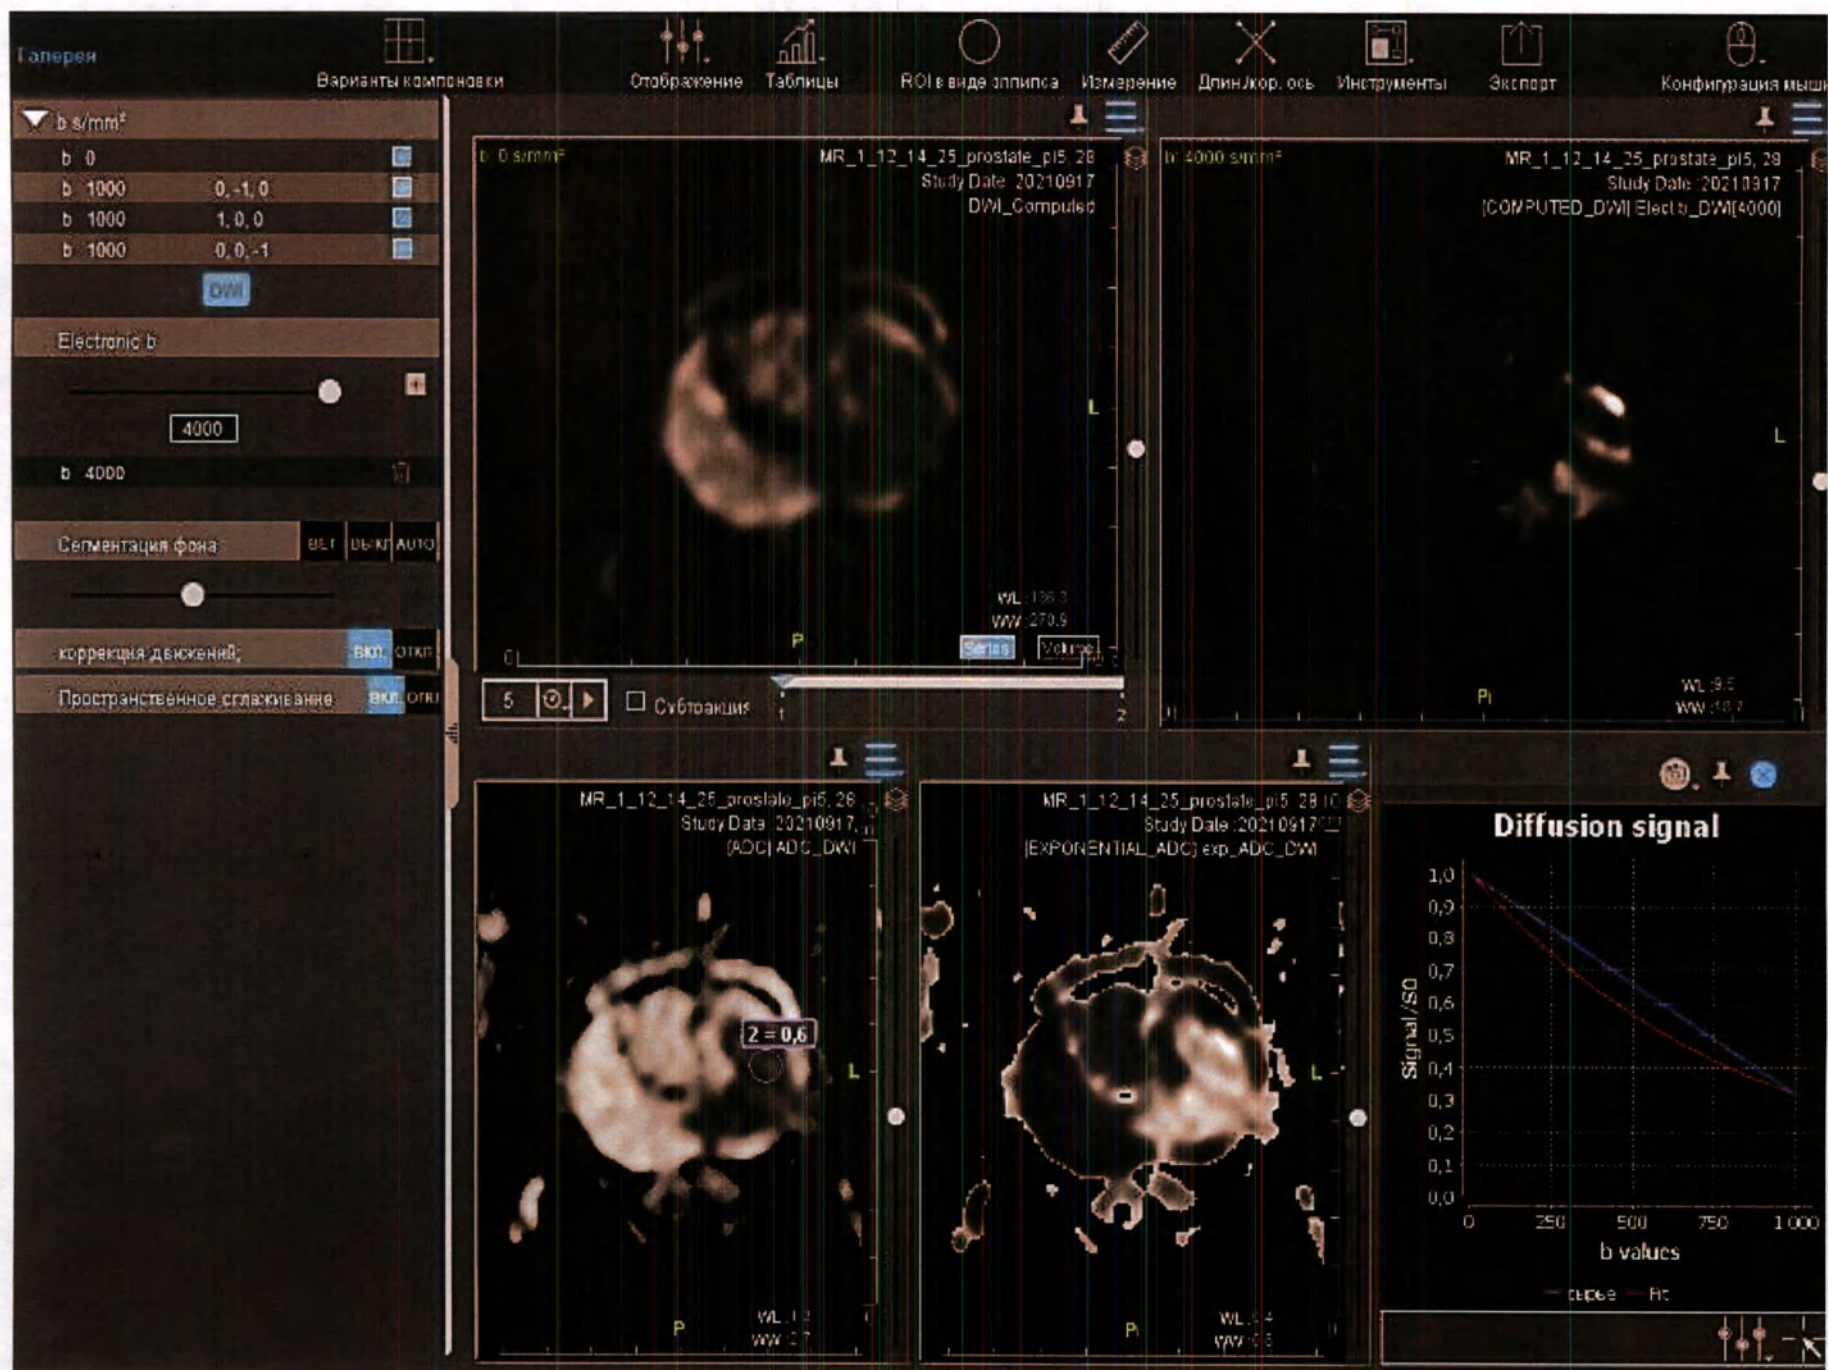


8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Perfusion)

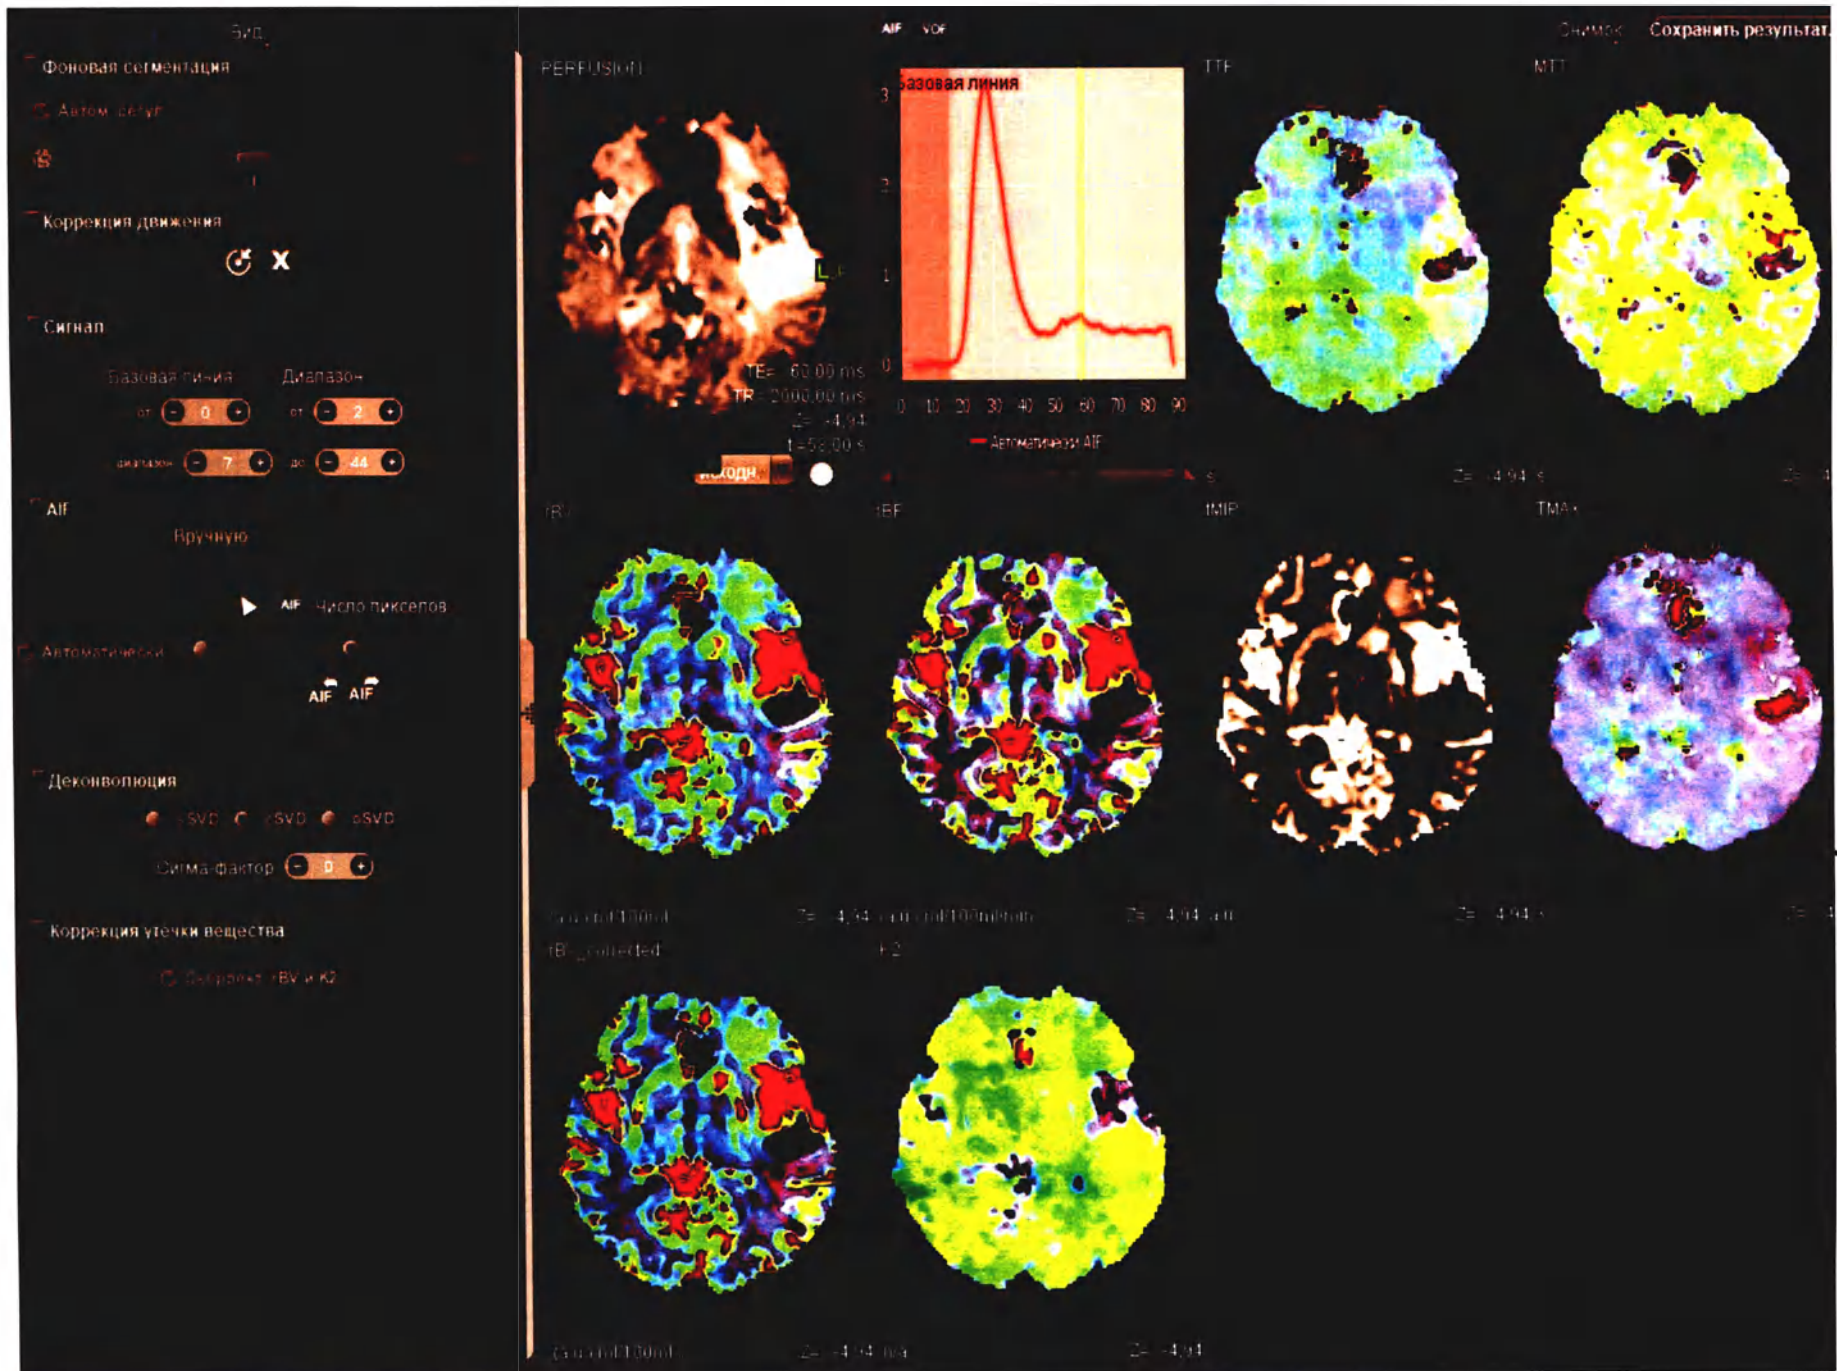

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Analysis)

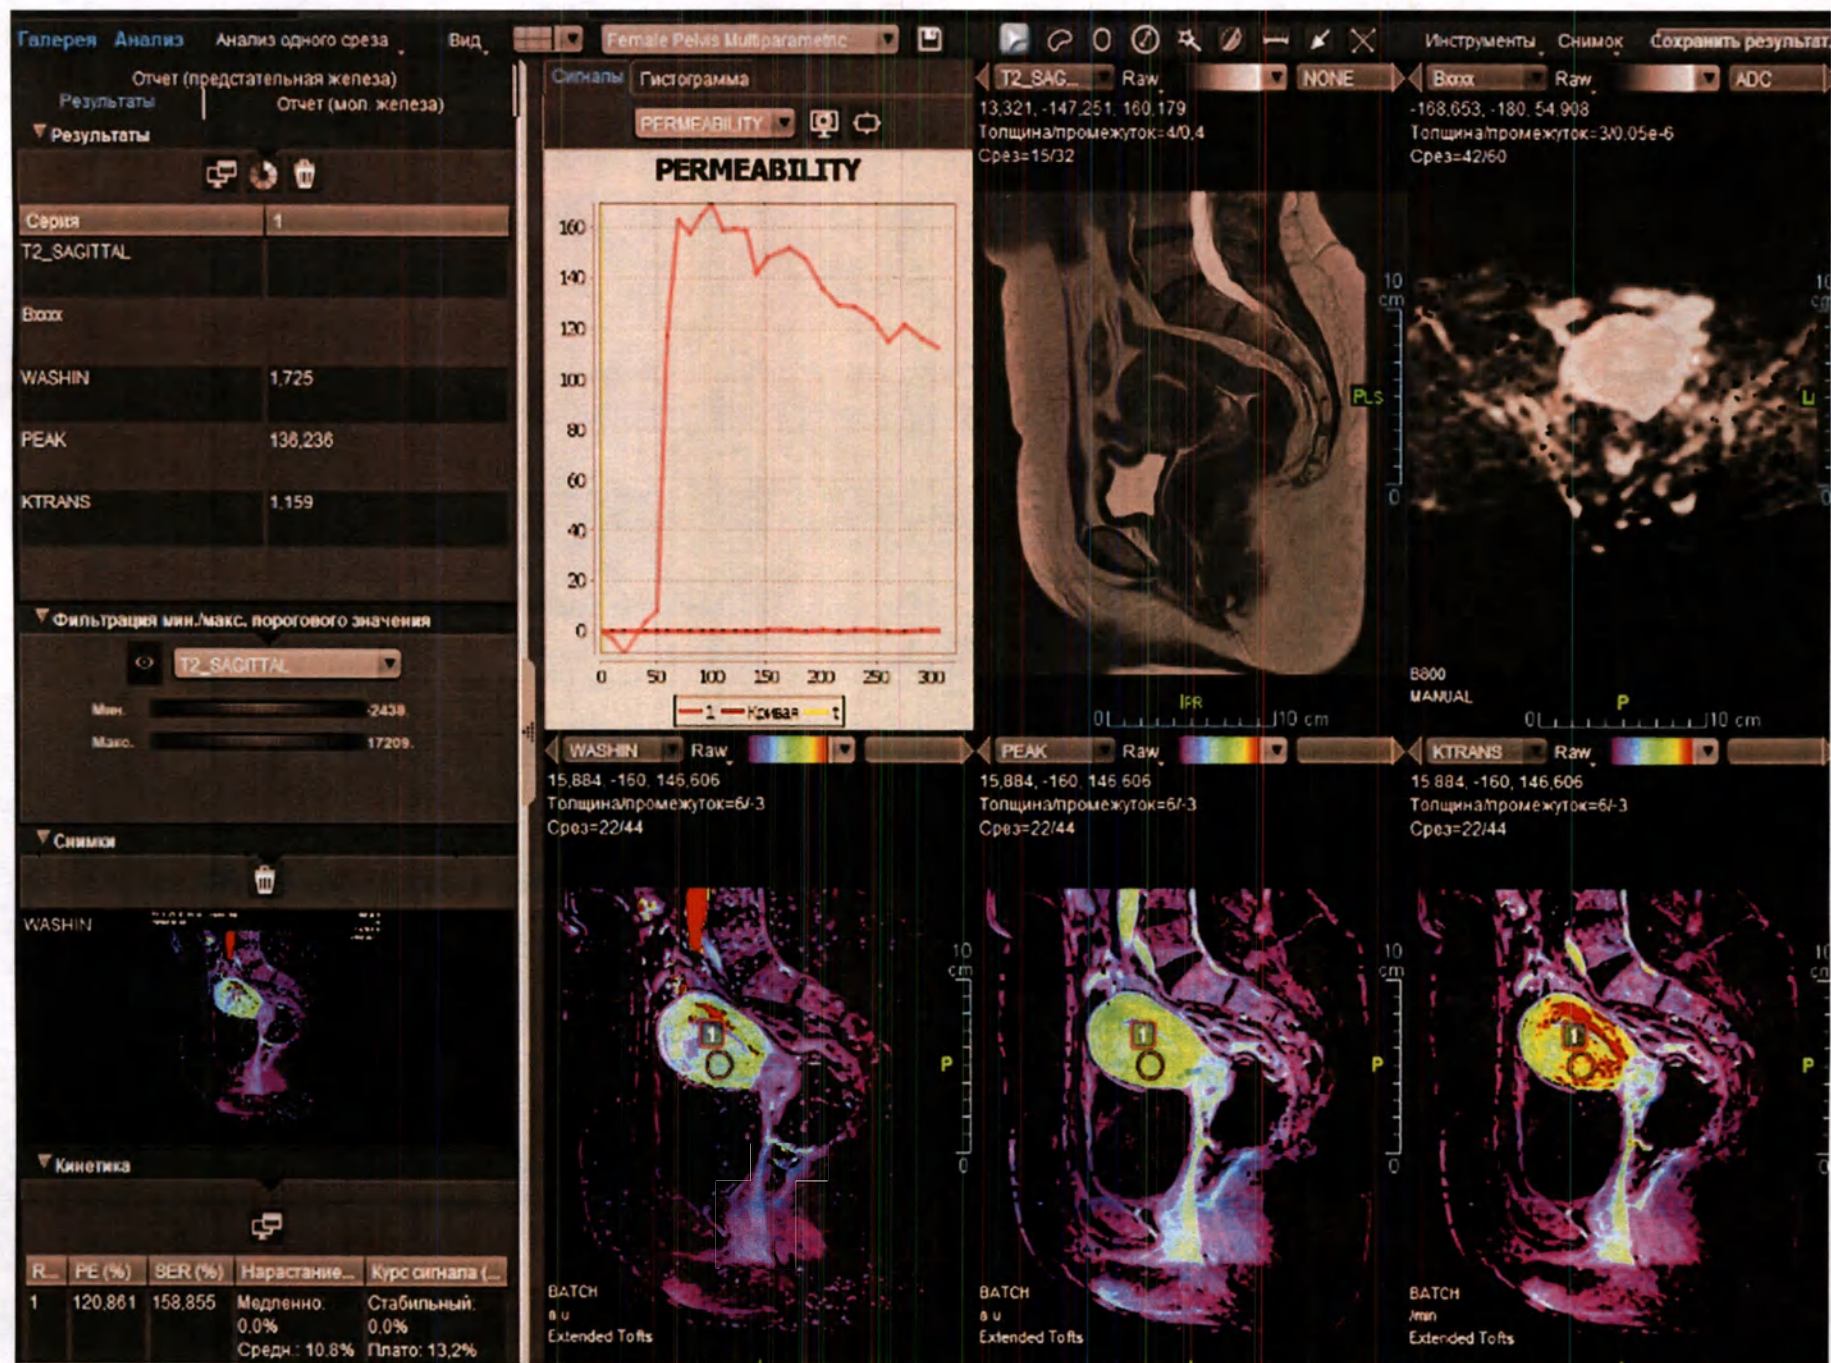

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Kinetics)

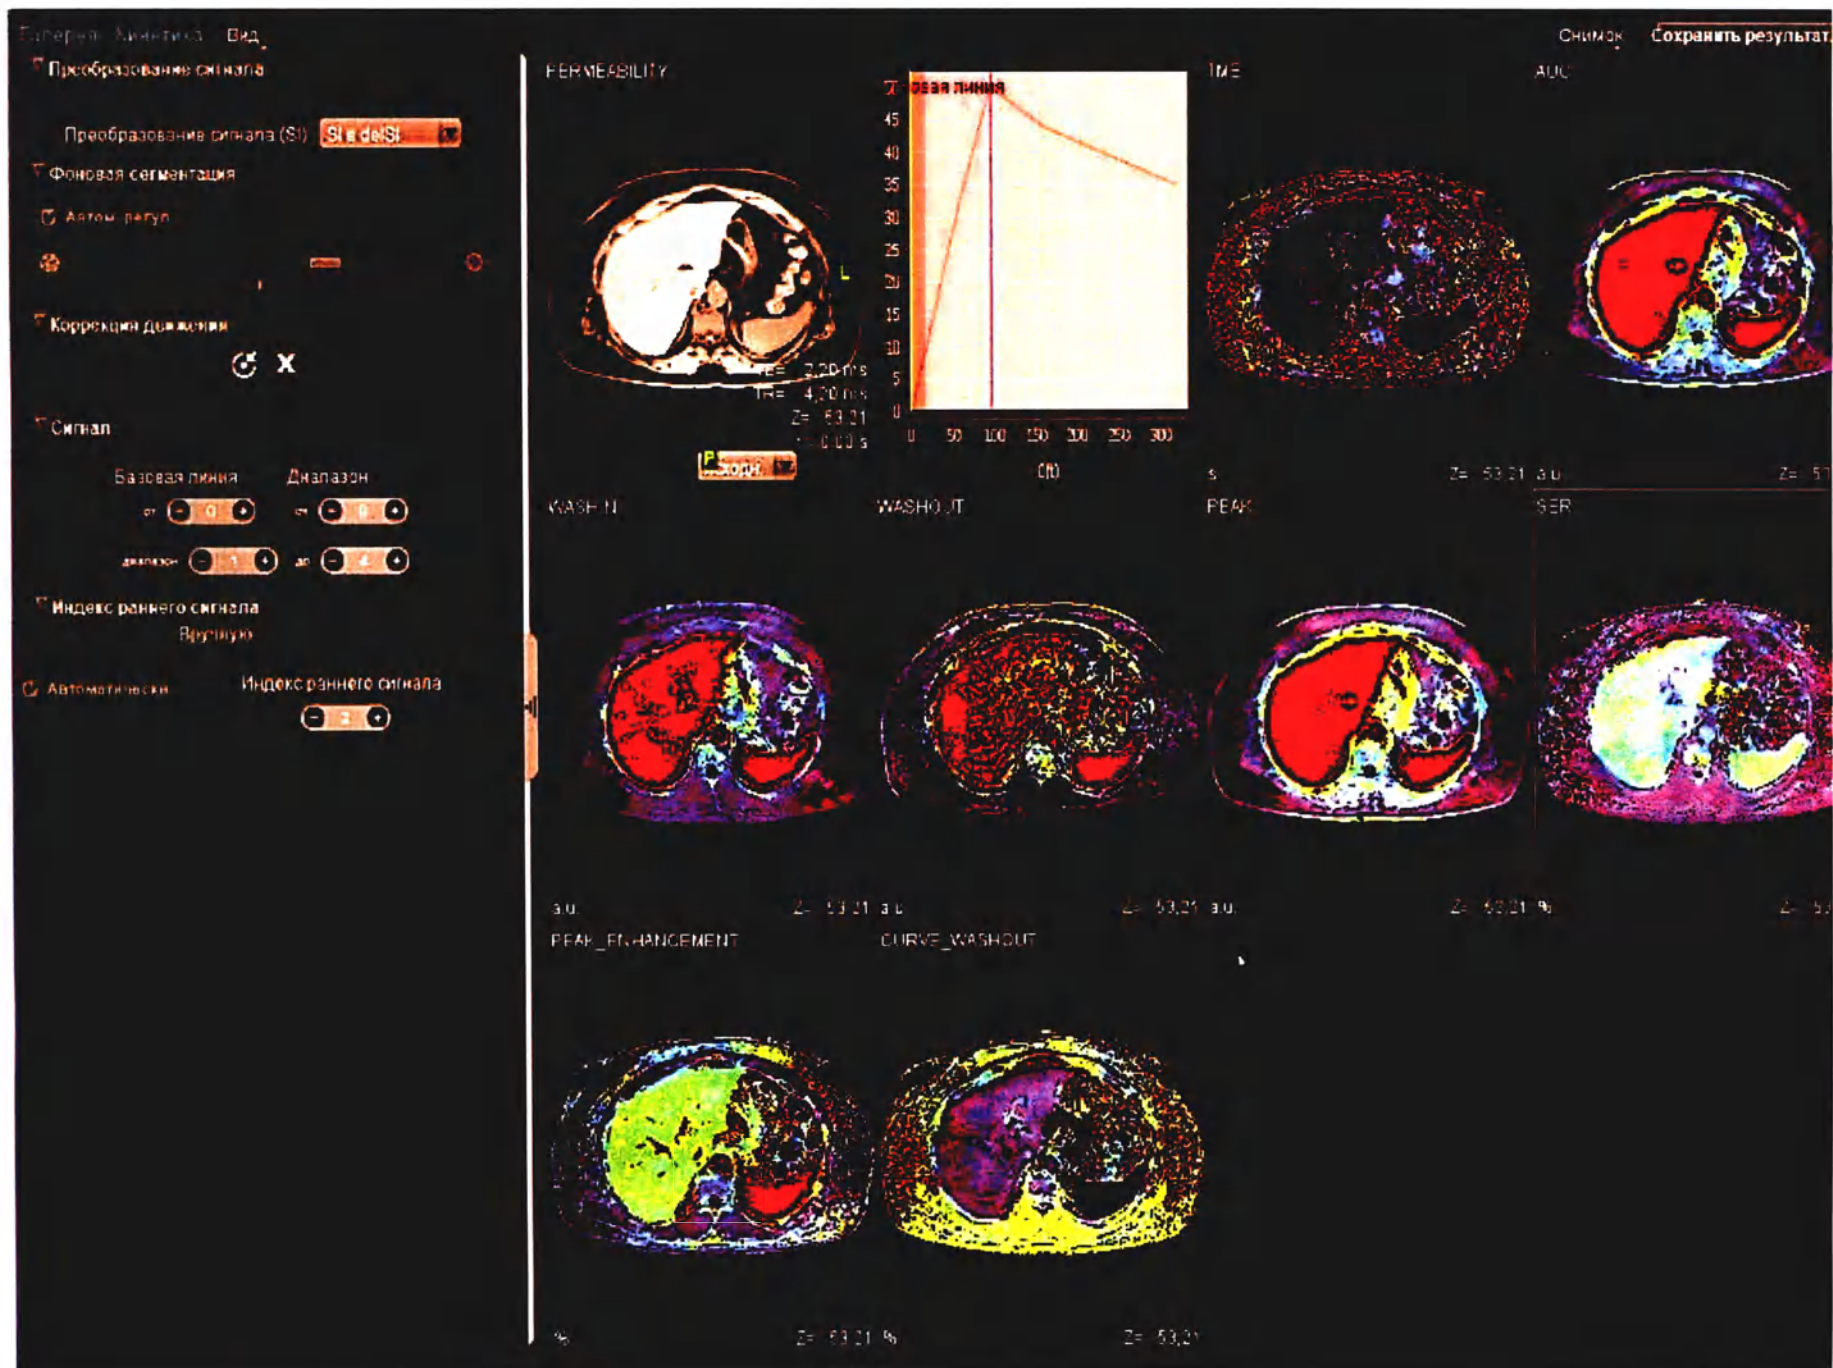

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Mono Follow-up)

Галерея Продольный анализ моно Сравнить Вид Empty Совмещение Снимок Сохранить результат

▼ Нормализация

Объединить
Сравнить
Сегментация объема

Тип серии: T1_GADO_SAGITTAL

Контрольная ROI: 1

2021 апр. 06 (15:33)

2021 июл. 16 (08:04)

T1_GAD... Raw NONE

34,401, -149,09, 155,124
Толщина/прогрессорток=1,6/0,8
Срез=125,7

1645,72

600,88

-444,00

17A

17A

Нормализация уже выполнена.

▼ Субтракция

S1

исследование: 2021 апр. 06 (15:33)

серия: T1_GADO_SAGITTAL

S2

исследование: 2021 июл. 16 (08:04)

серия: T1_GADO_SAGITTAL

Формула

S2-S1

☐ Принять отрицательные значения

Управление


S1 S2

S2-S1: T1_GADO_SAGITTAL T1_GADO_SAGITTAL


Расширенные результаты

Исслед.	Имя	Серия	Сред.	Эвоп. М (%)	Мин.	Макс.	Станд. откл.	Площадь (м...)	Число	Отношение	Эво.
2021 апр. 06 ...	1	T1_GADO_SAGITTAL	863,295	Нет	435,026	1180,01	129,379	164,25	657	Нет	Нет
2021 апр. 06 ...	2	T1_GADO_SAGITTAL	866,648	Нет	640,974	1165,99	99,358	182,25	729	Нет	Нет
2021 апр. 06 ...	3	T1_GADO_SAGITTAL	878,668	Нет	512,022	1180,01	119,945	135,5	542	Нет	Нет
2021 июл. 16 ...	1	T1_GADO_SAGITTAL	863,276	-2,174e-3	481,222	1121,77	129,377	164,25	657	Нет	Нет
2021 июл. 16 ...	2	T1_GADO_SAGITTAL	822,261	-7,262	388,581	1160,87	162,634	182,25	729	Нет	Нет
2021 июл. 16 ...	3	T1_GADO_SAGITTAL	905,812	3,066	695,507	1121,77	94,205	135,5	542	Нет	Нет
subtract	1	S2-S1 S1=T1_GADO_S...	62,727	Нет	-6,939e-18	495,235	103,314	164,25	657	Нет	Нет
subtract	2	S2-S1 S1=T1_GADO_S...	42,835	Нет	-6,939e-18	382,021	79,894	182,25	729	Нет	Нет
subtract	3	S2-S1 S1=T1_GADO_S...	75,309	Нет	-6,939e-18	495,235	109,257	135,5	542	Нет	Нет

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (MR Acute Care Stroke)

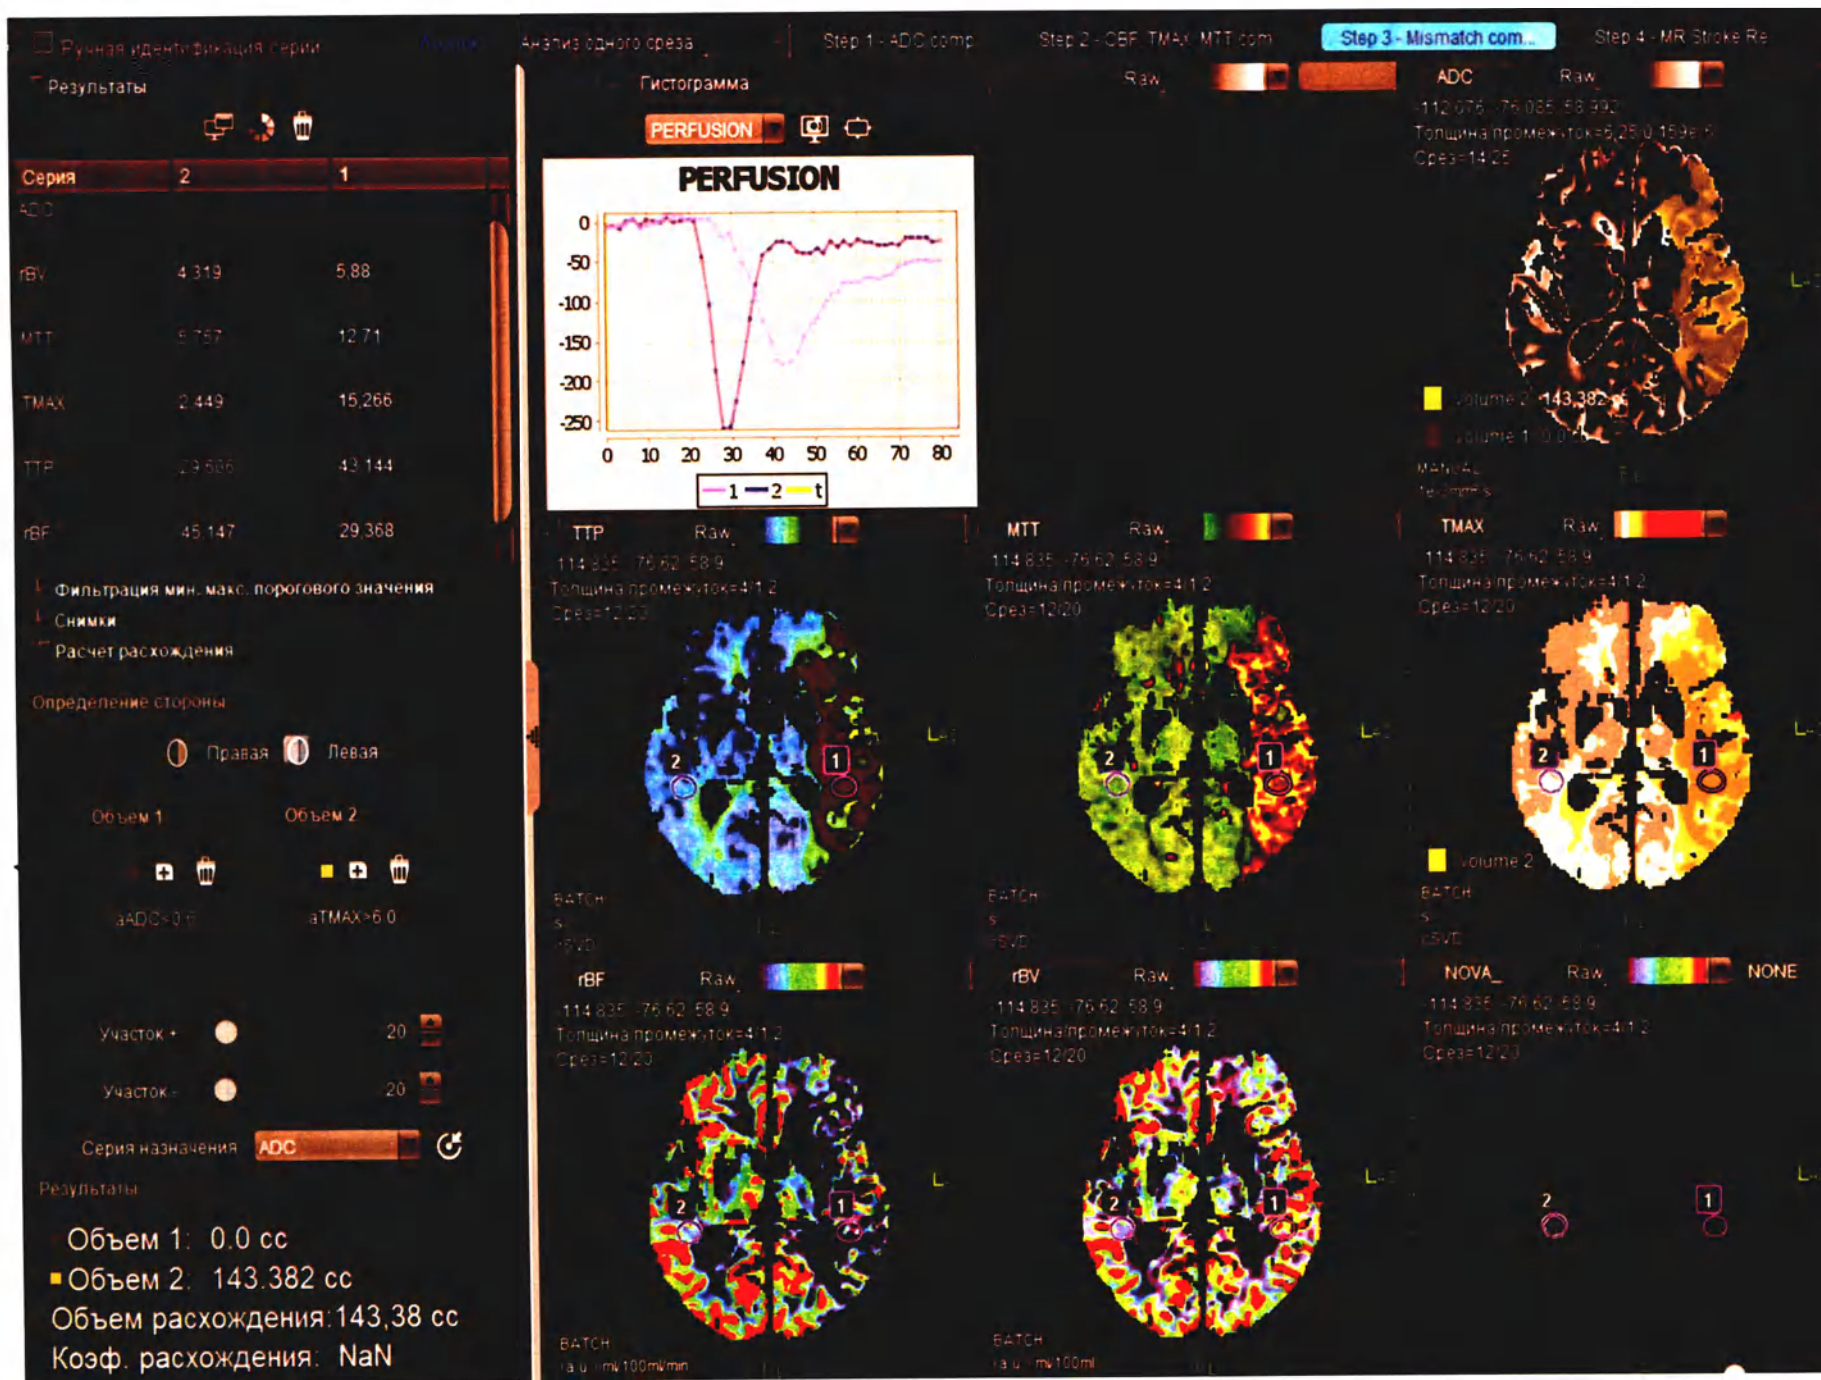


8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (MR Stroke DWI)

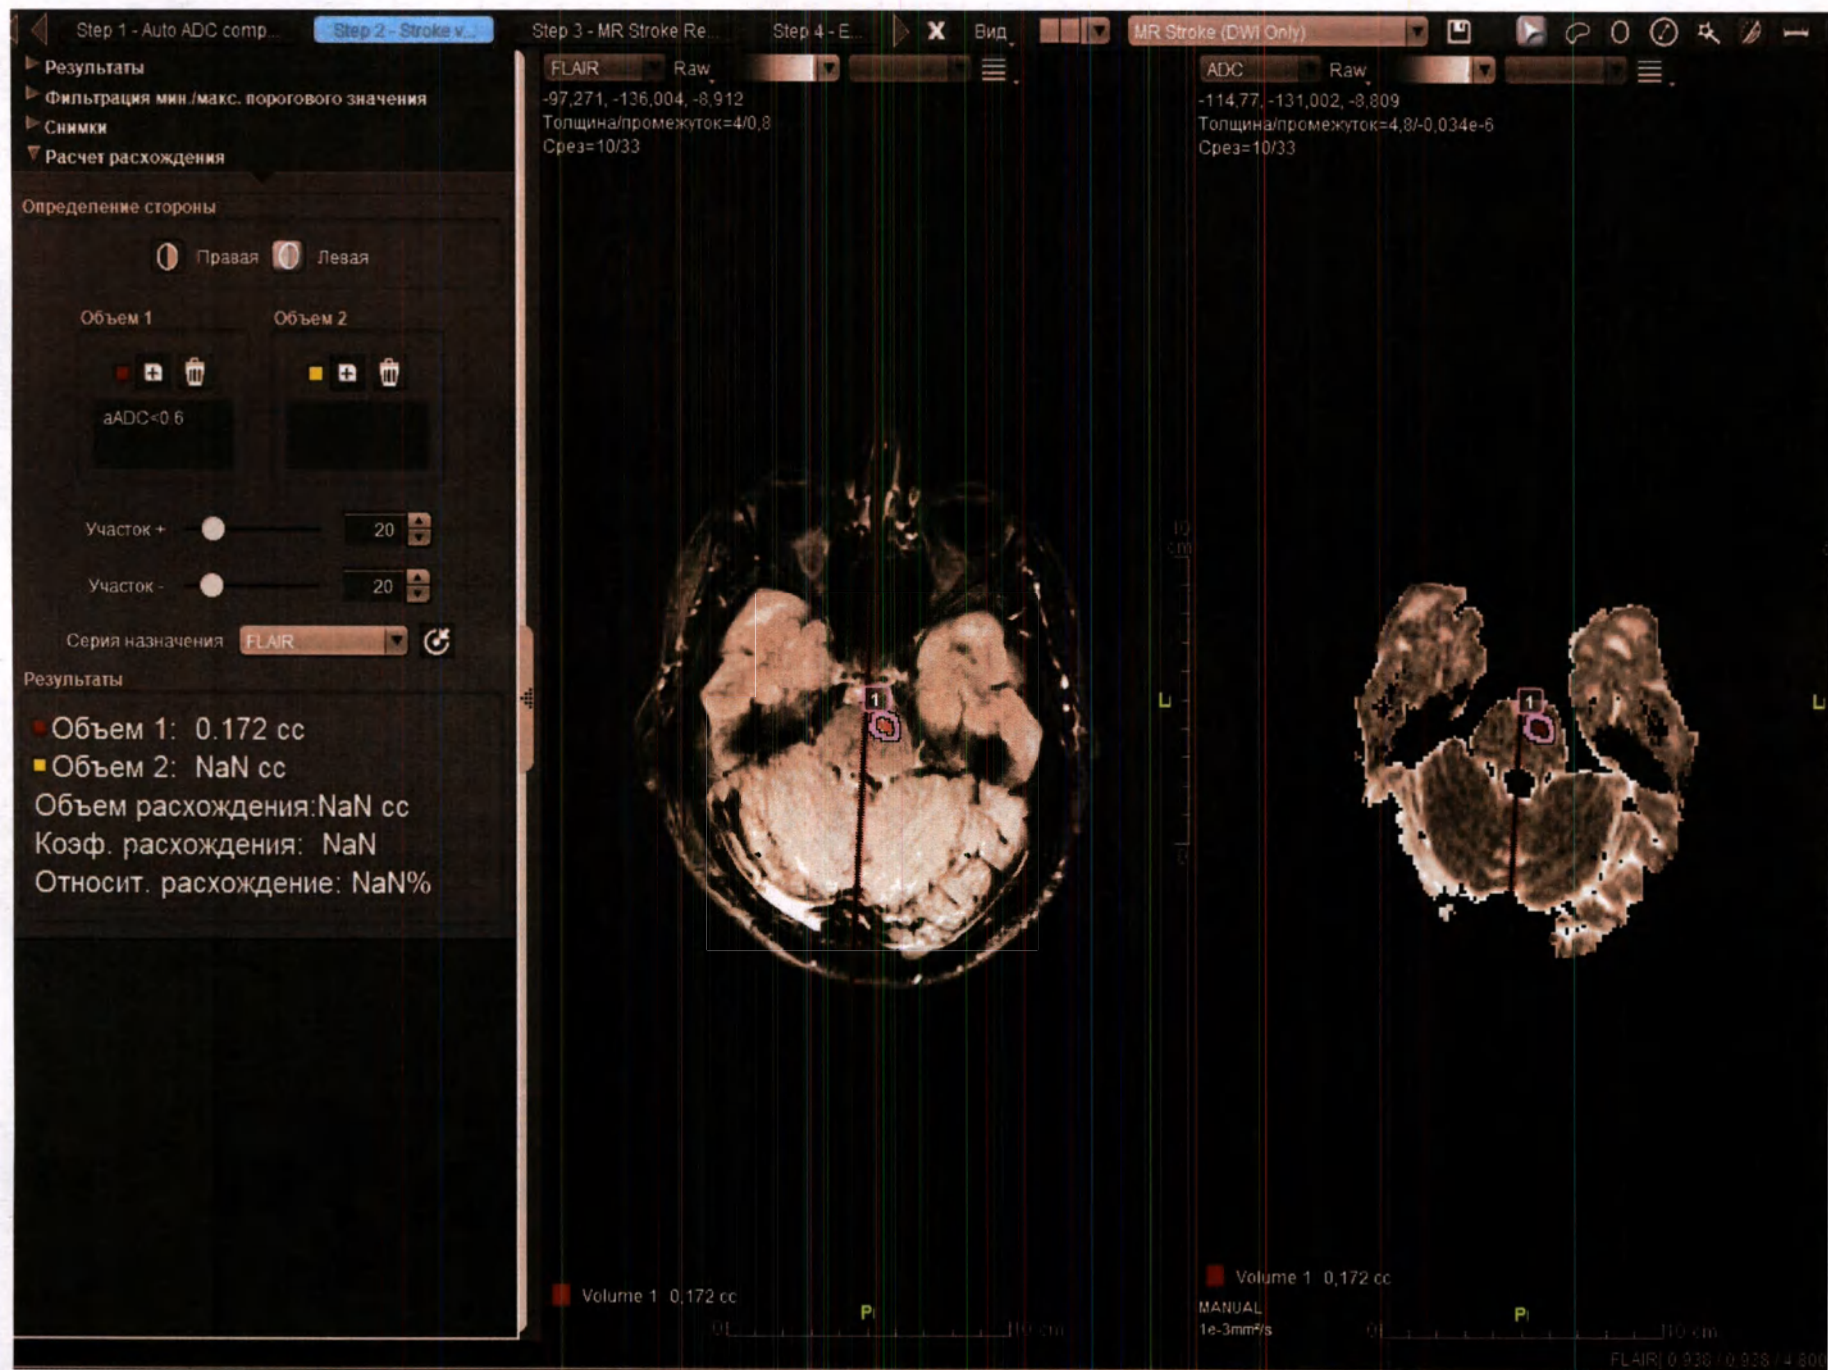

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Brain Tumor Streamlined)




8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Head Neck Streamlined)

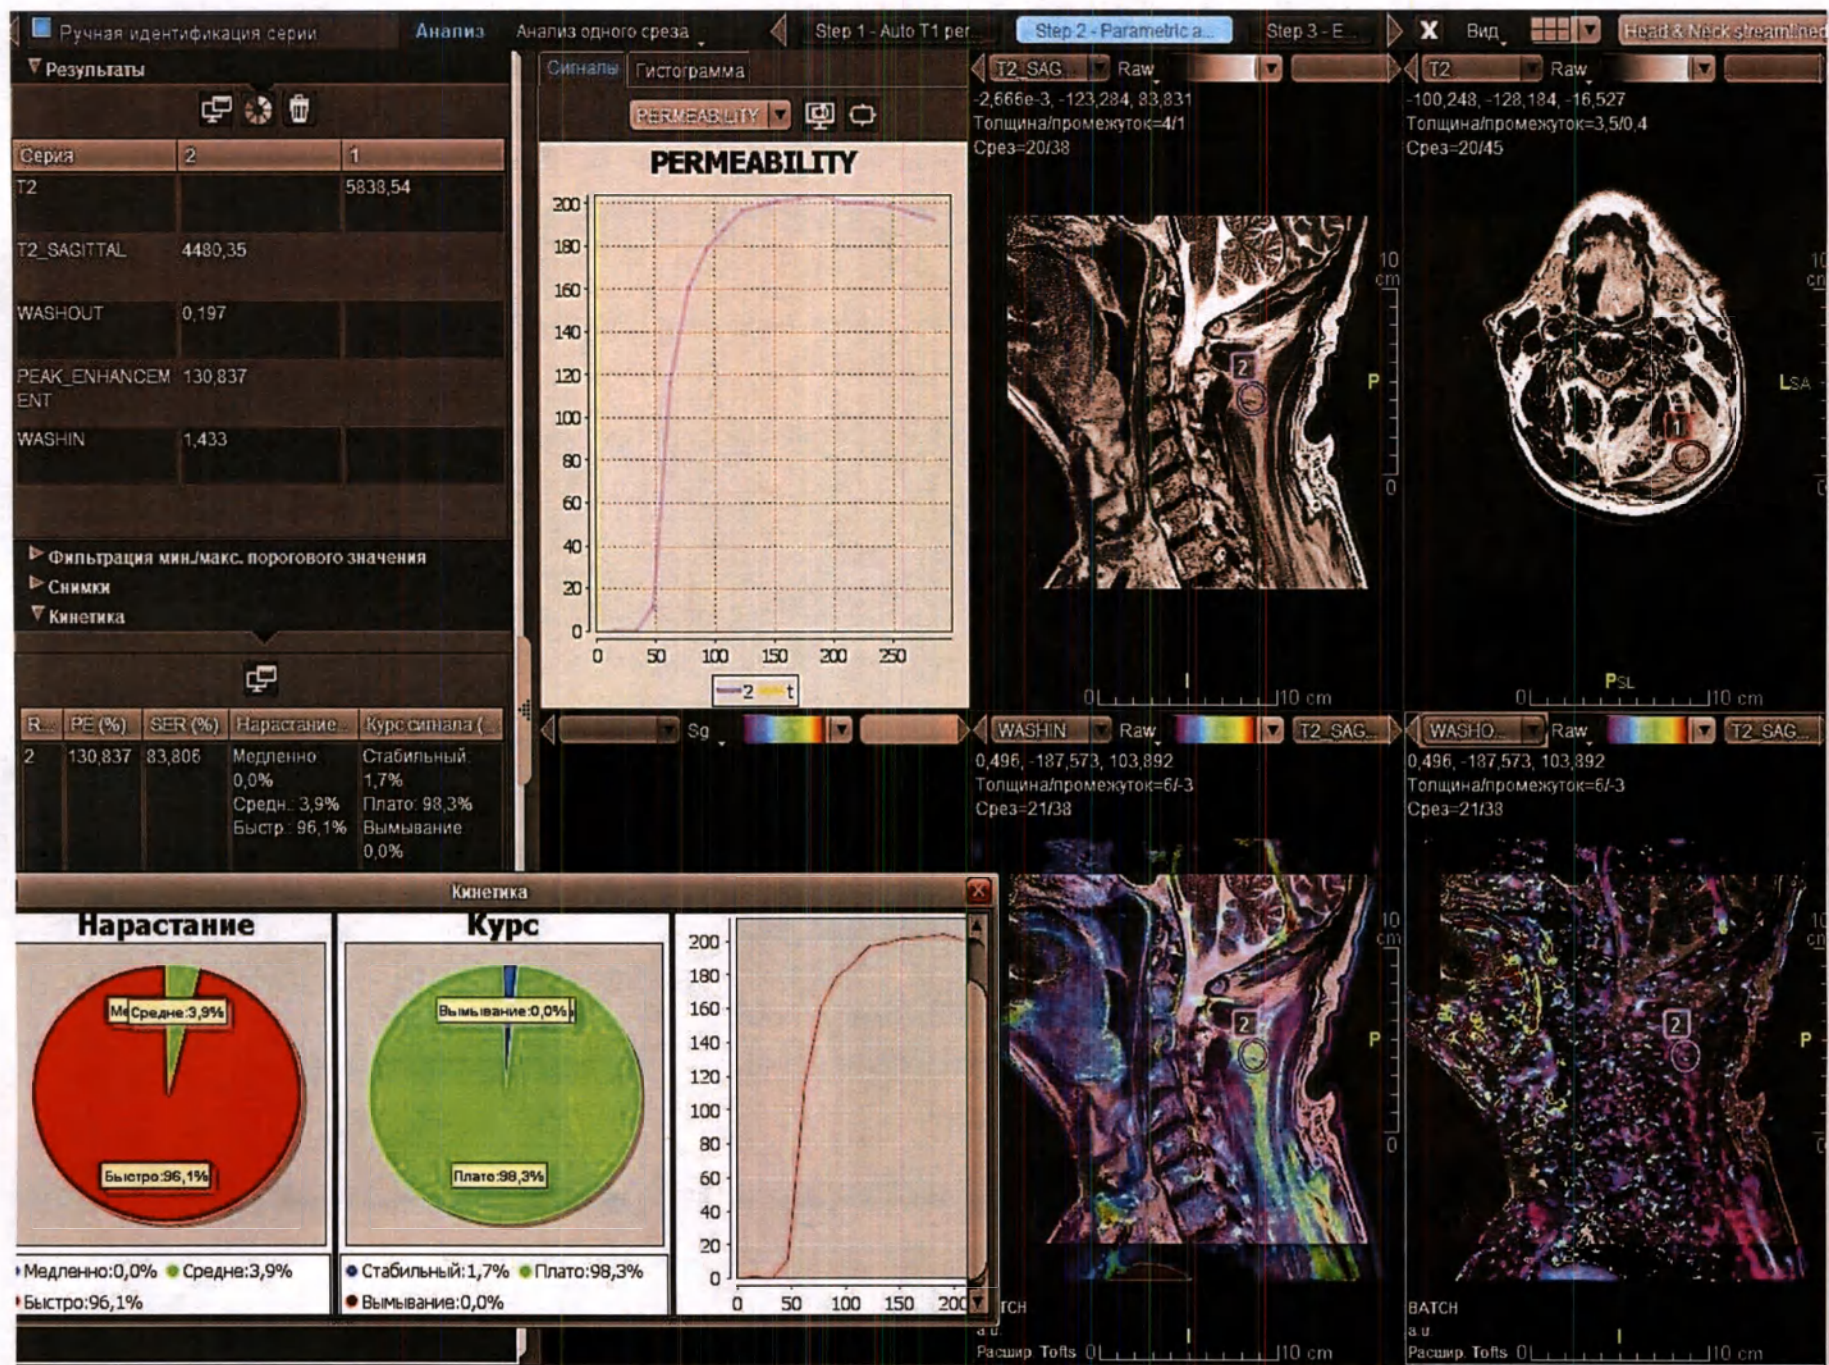

8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Breast Streamlined)



8. Программный пакет для МР-анализа внутренних органов и тканей (при необходимости) (Prostate Streamlined)

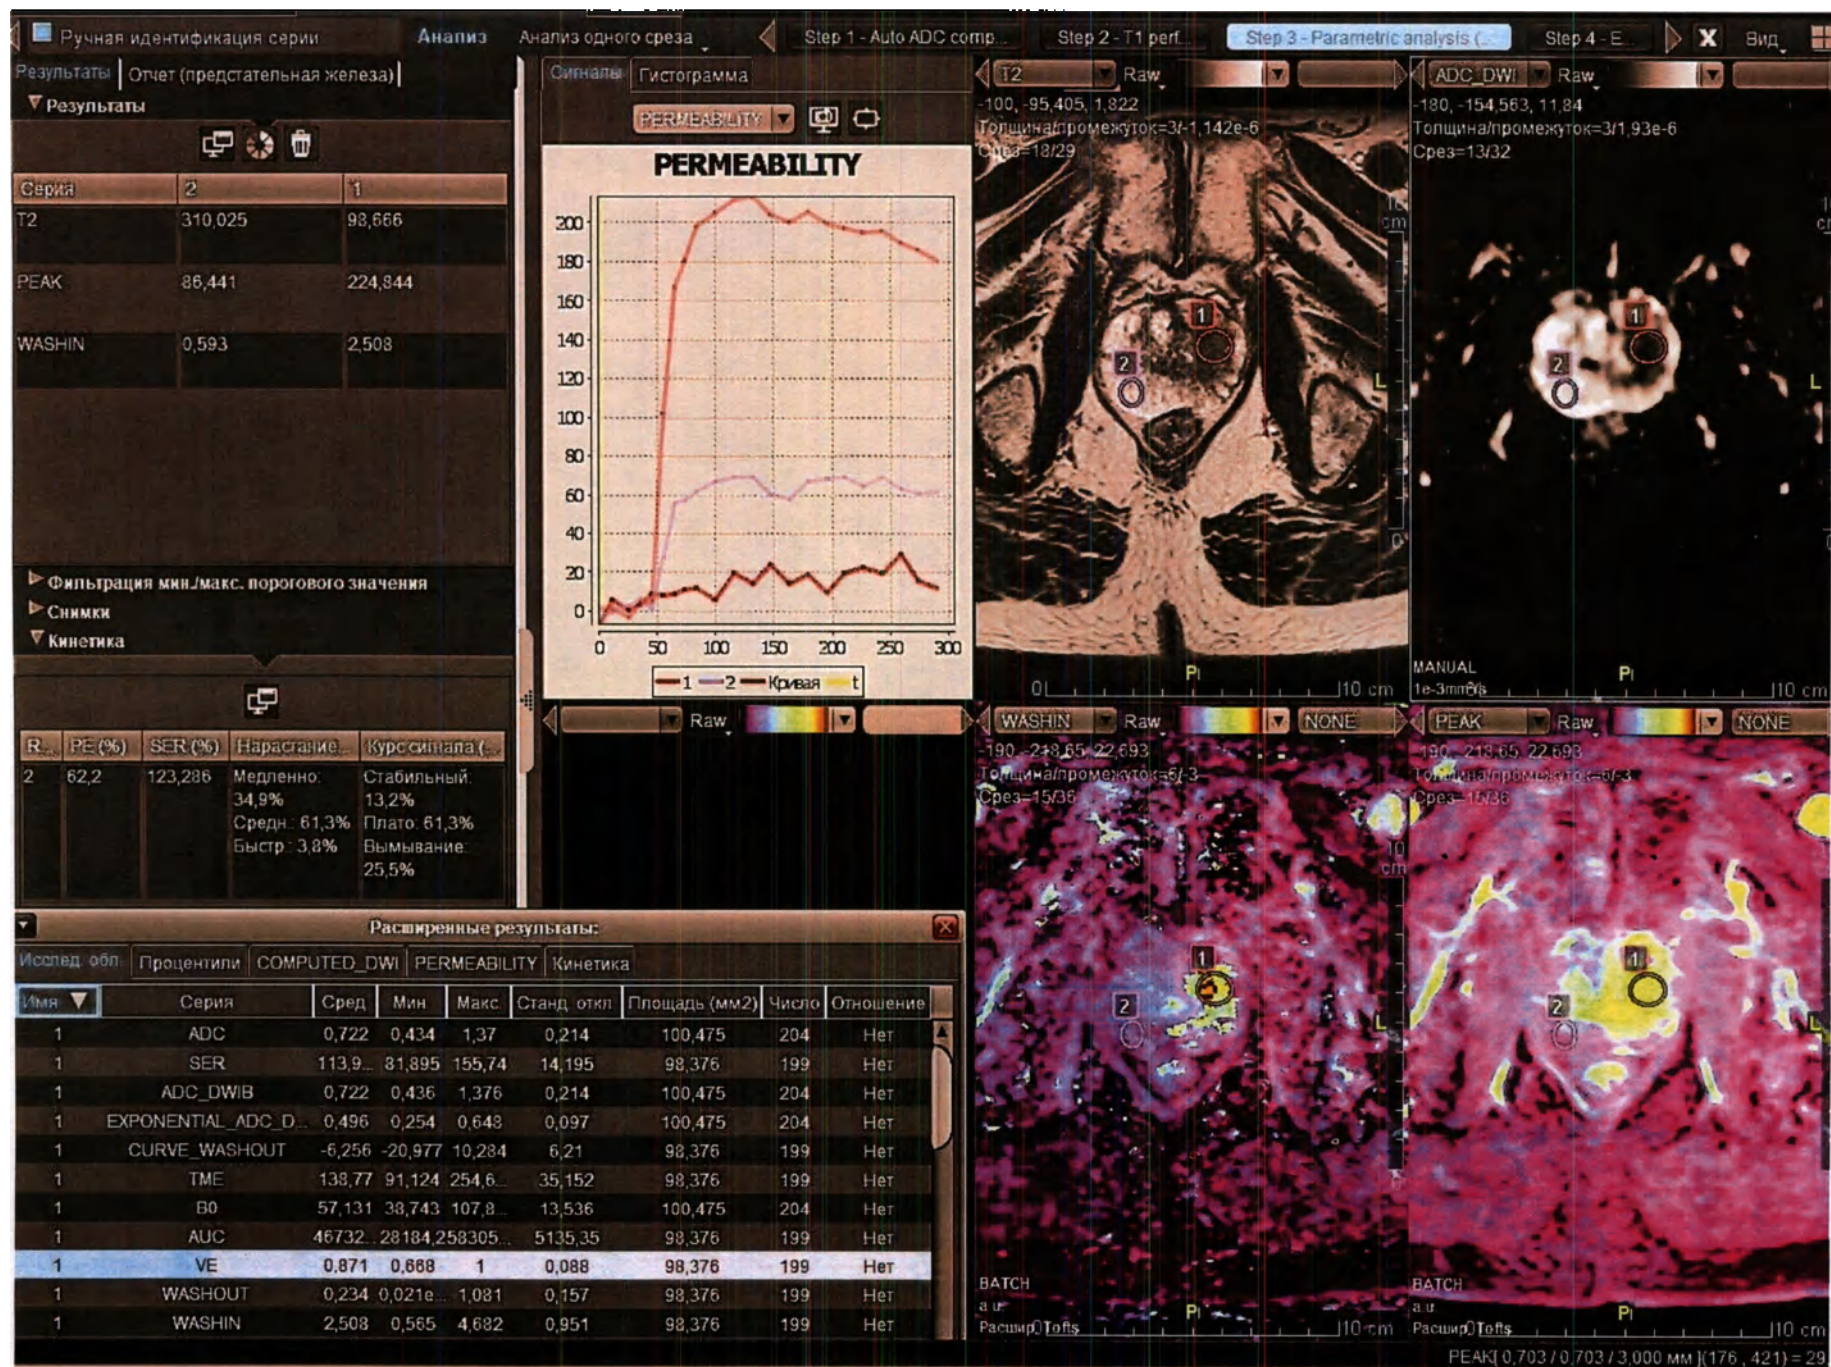

9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (DTI)

Галерея

Варианты компоновки

Отображение Таблицы ROI в виде эллипса Измерение Длин./кор. ось Инструменты Экспорт Конфигурация мыши

Отображение Визуализация Основное/Снизу Pick Тип MPR

DTI BOLD

▼ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОИСК

Алгоритм DTI FACT

▼ ИСЧЕТНАЯ СТАТИСТИКА BOLD

Подсчет (вокселей)	699 396
Макс.	1.00
Ср.	0.62
Медиана	0.58
Мин.	0.20
Sd	0.25
Объем (куб. см)	1 206.54

▼ ПОИСК ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ

Проверьте Искривление


Полигональная область исследования Эллиптическая область исследования

ТРАКТЫ	TRACT 1	TRACT 2
+	+	+
SEED 1	ИПИ	Включить
SEED 2	Нет	Нет
	Кол-во волокон	Кол-во волокон
	68122	68122


▼ ПОКАЗАТЬ

▶ ОТЛЕЖИВАТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ


9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (Permeability)

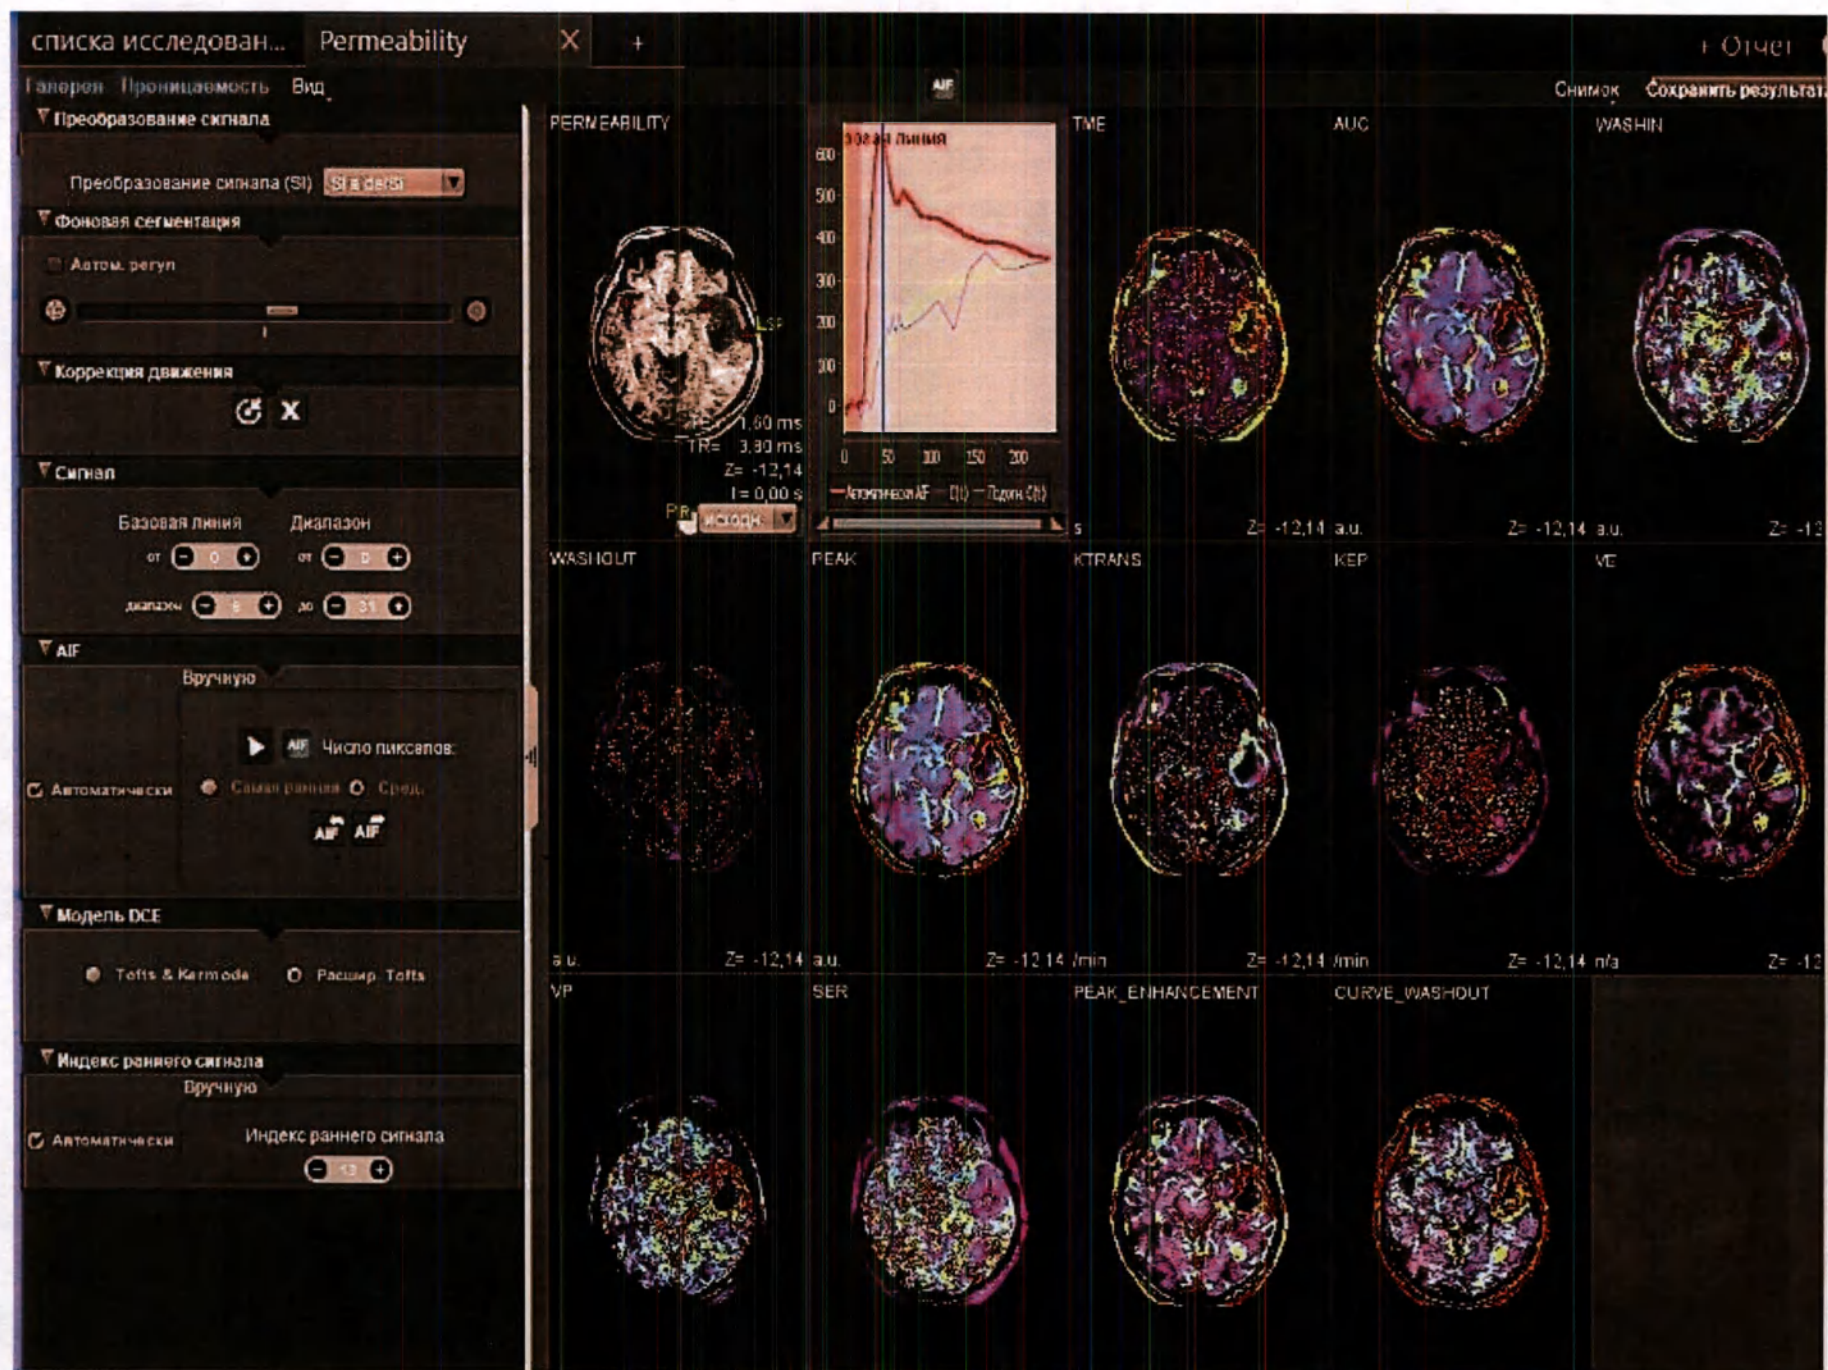

9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (ASL)

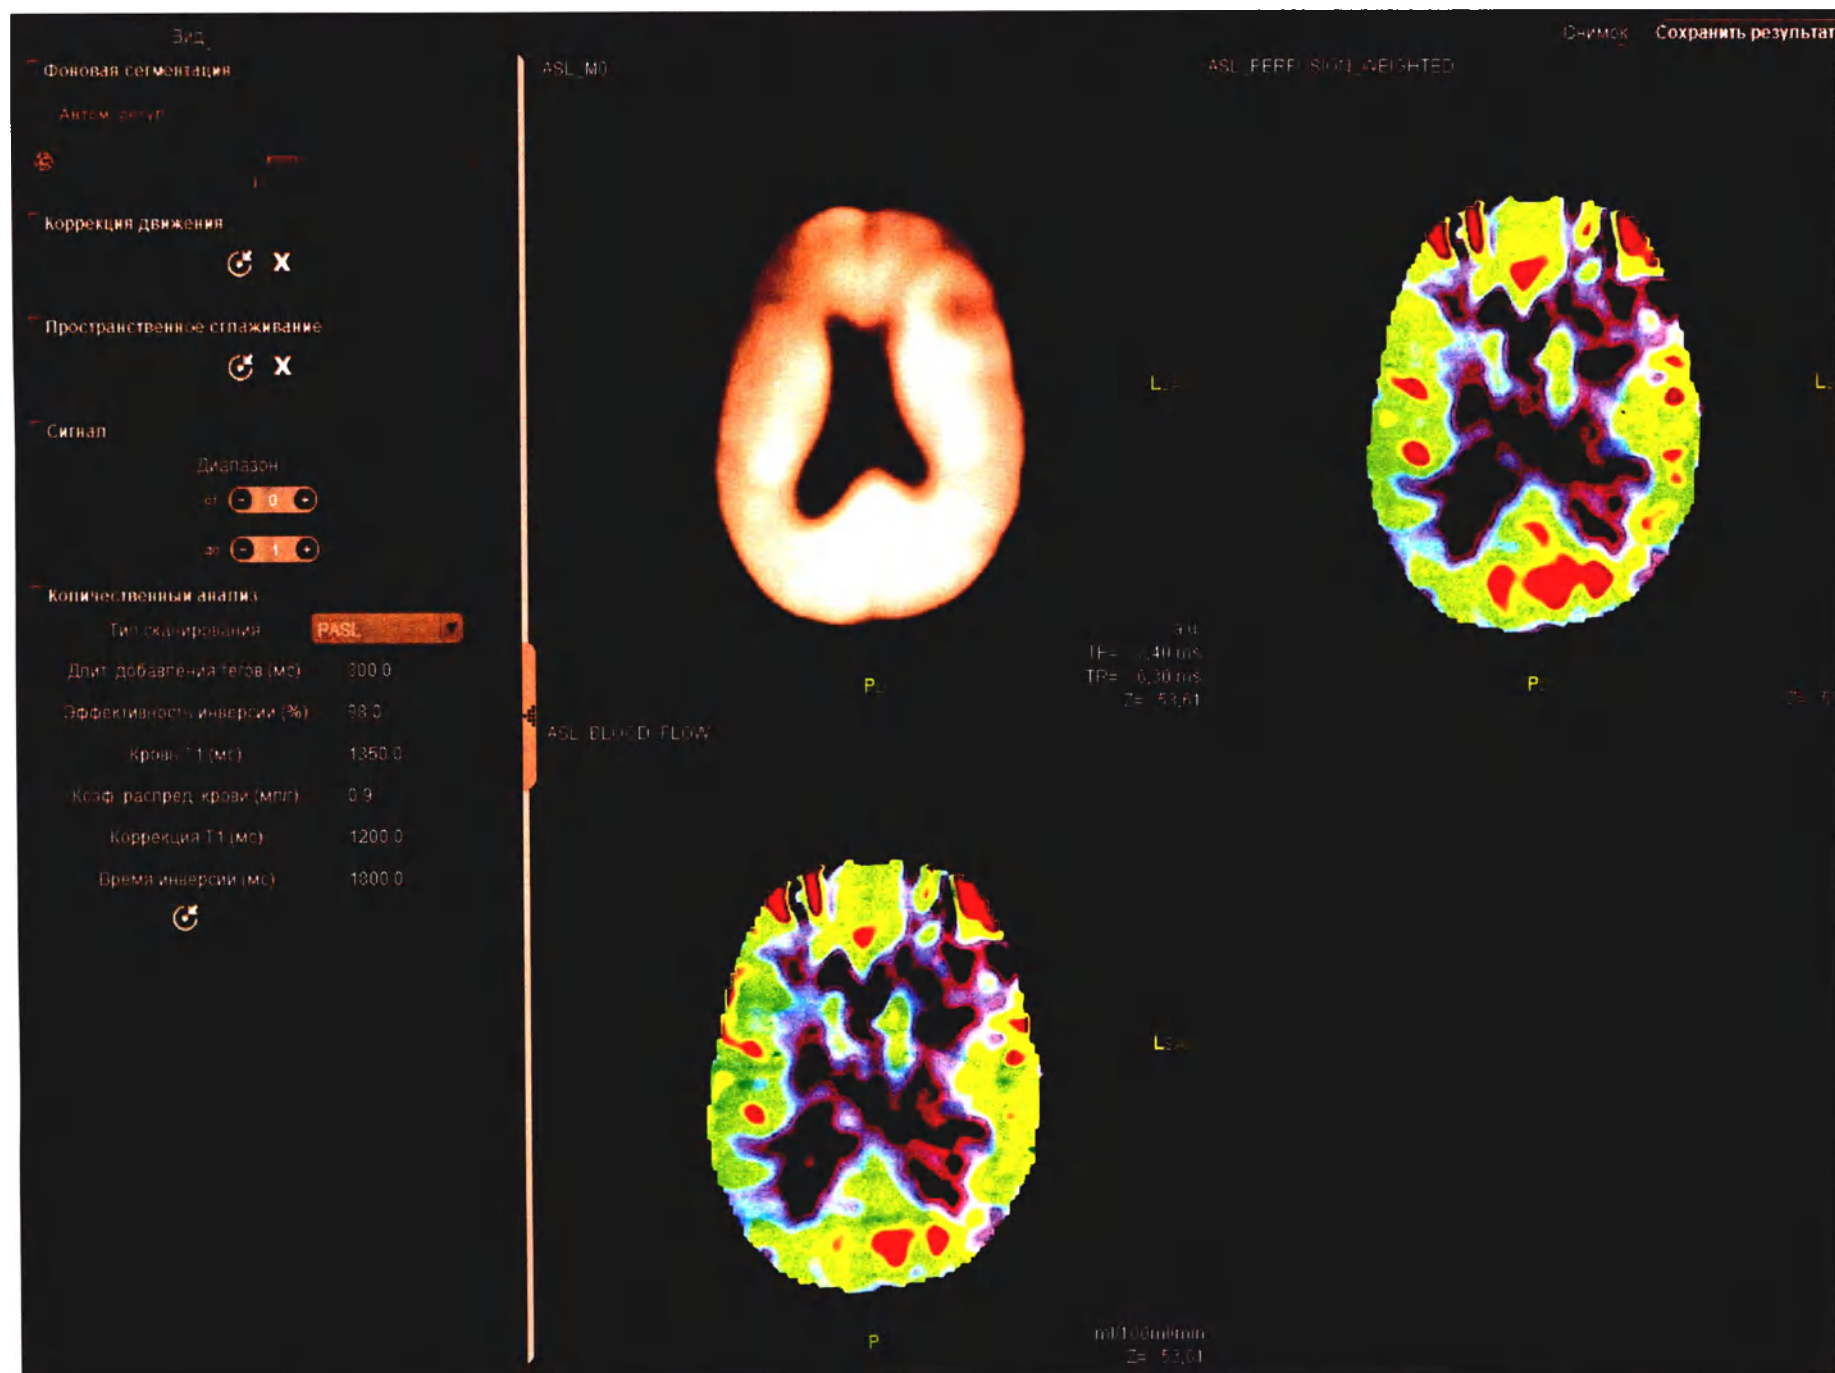


9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (IVIM)

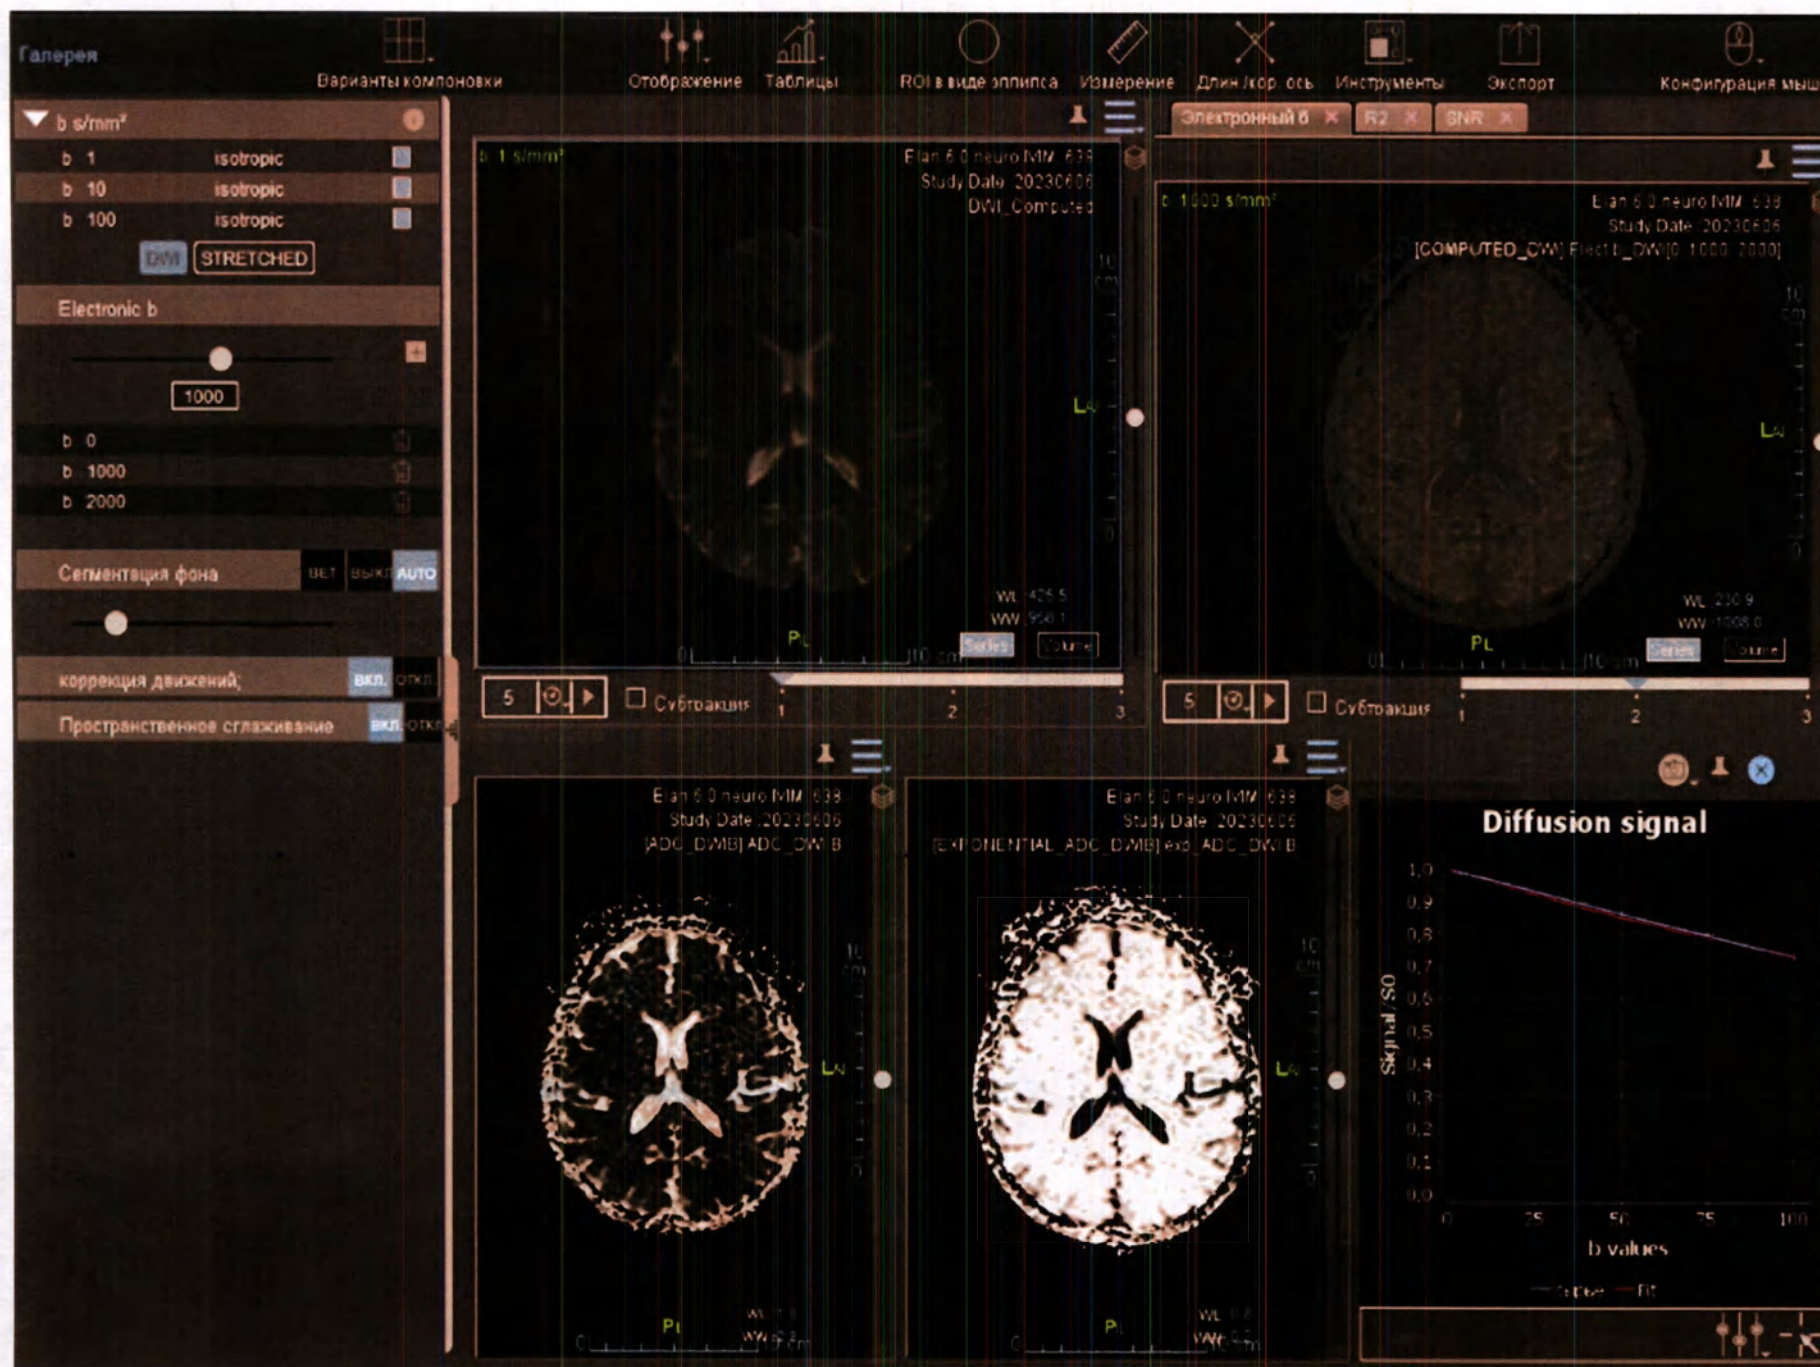


9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (Brain Tumor Expanded)




9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (Brain Tumor DSCDCE Expanded)

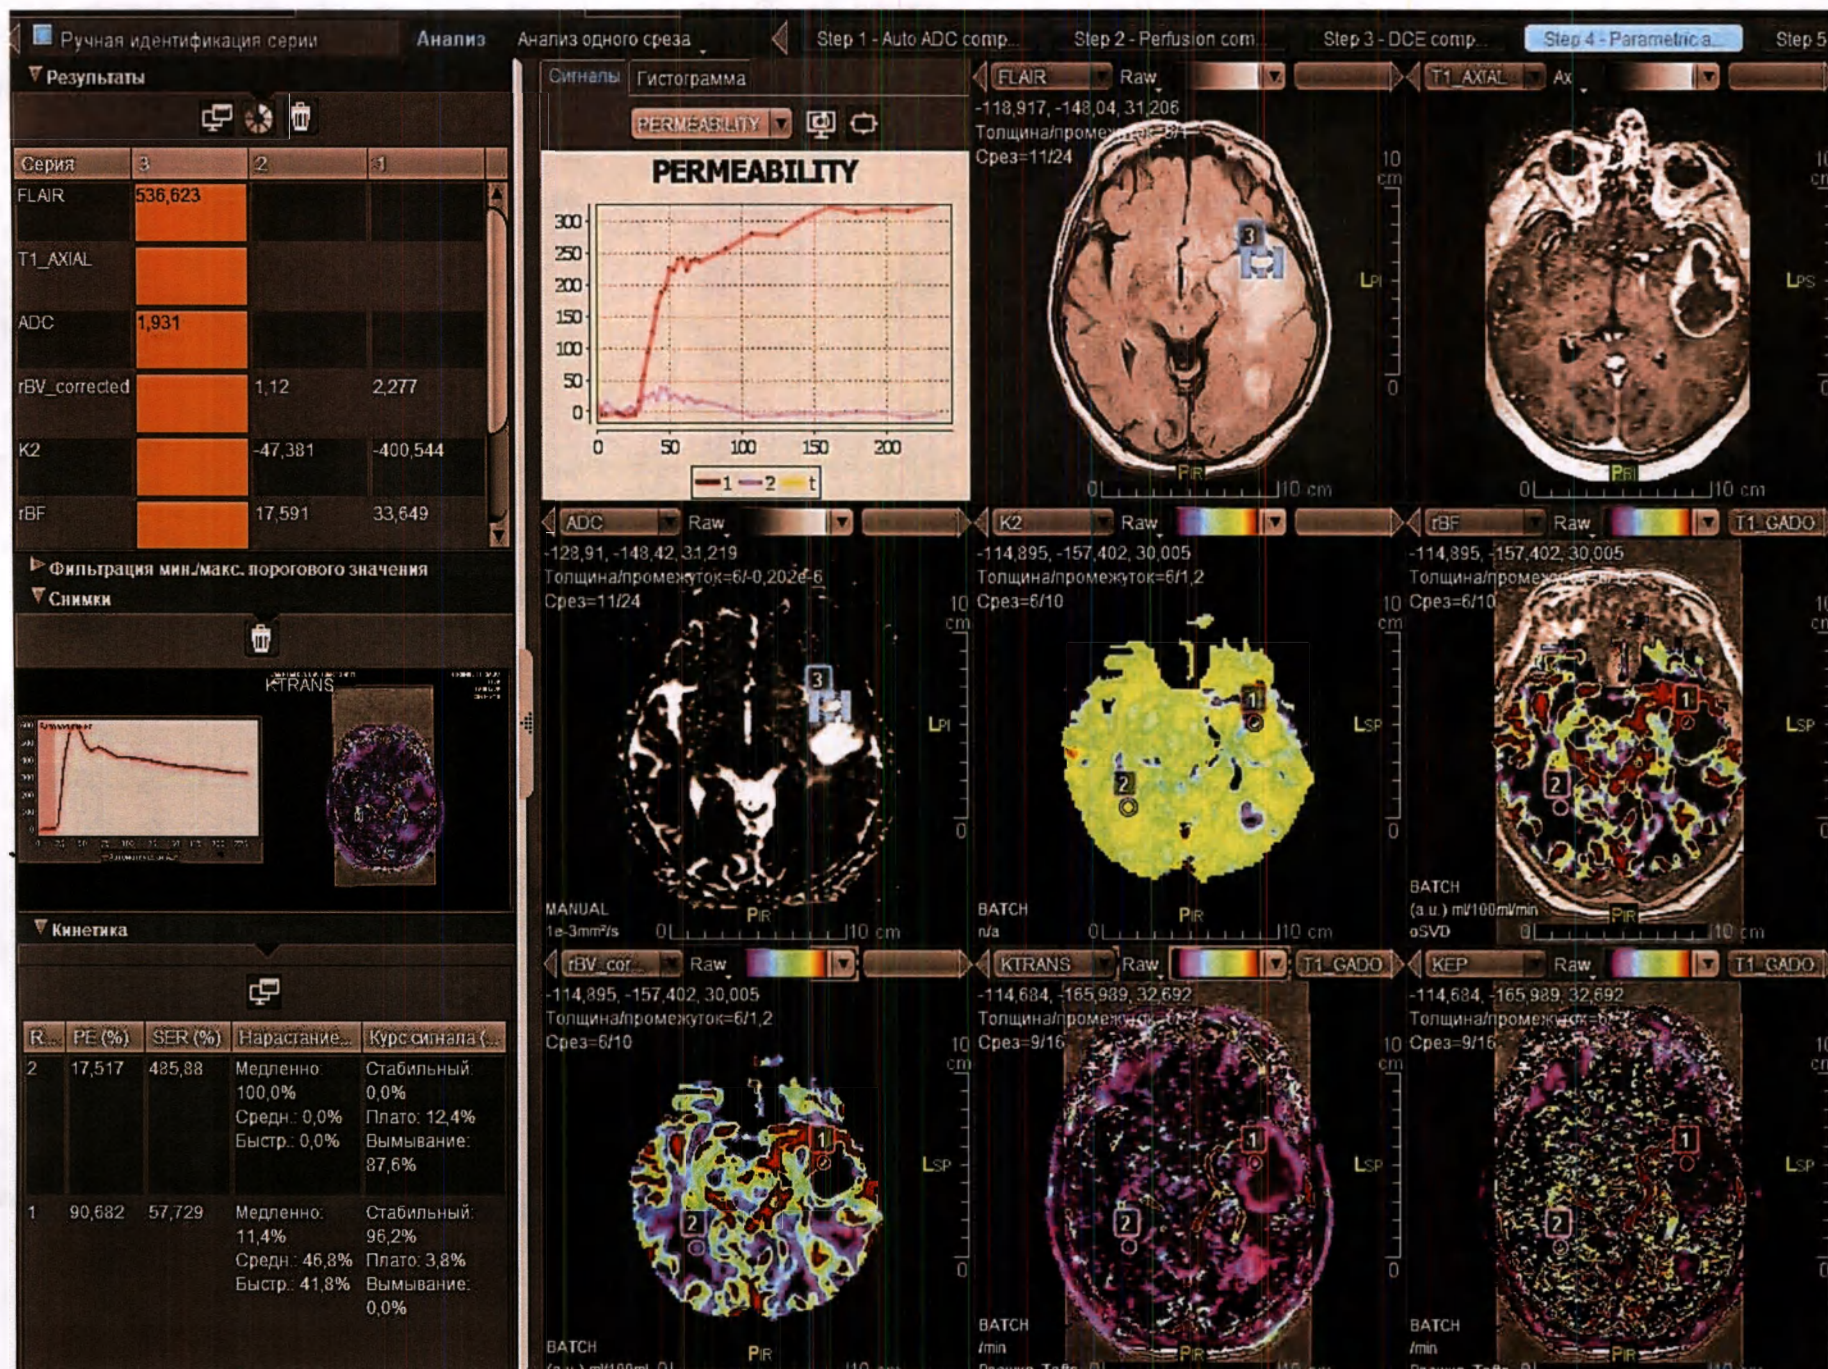


9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (Brain Tumore DCE)

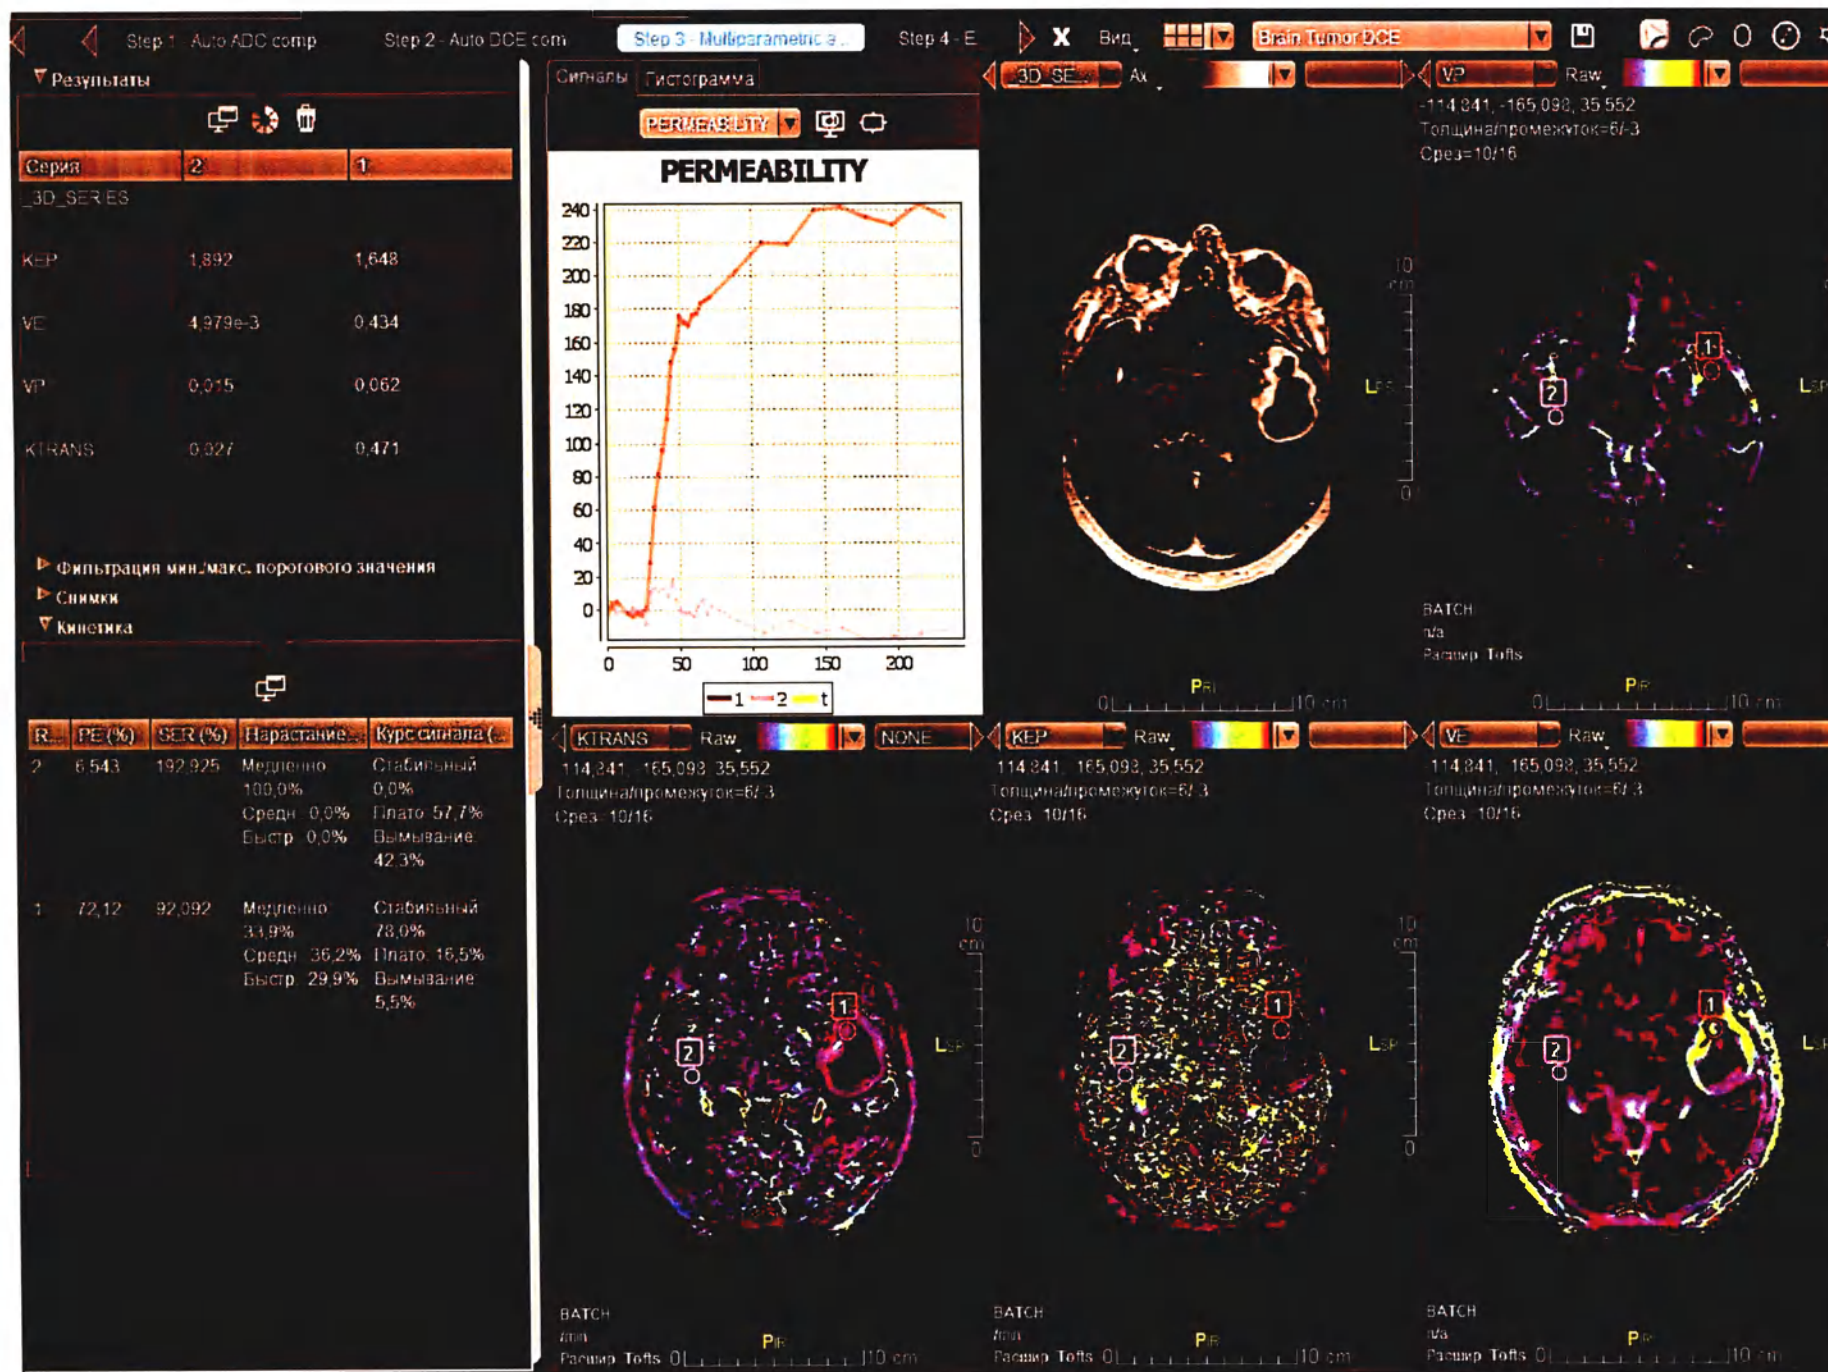

9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (DTI Spine)

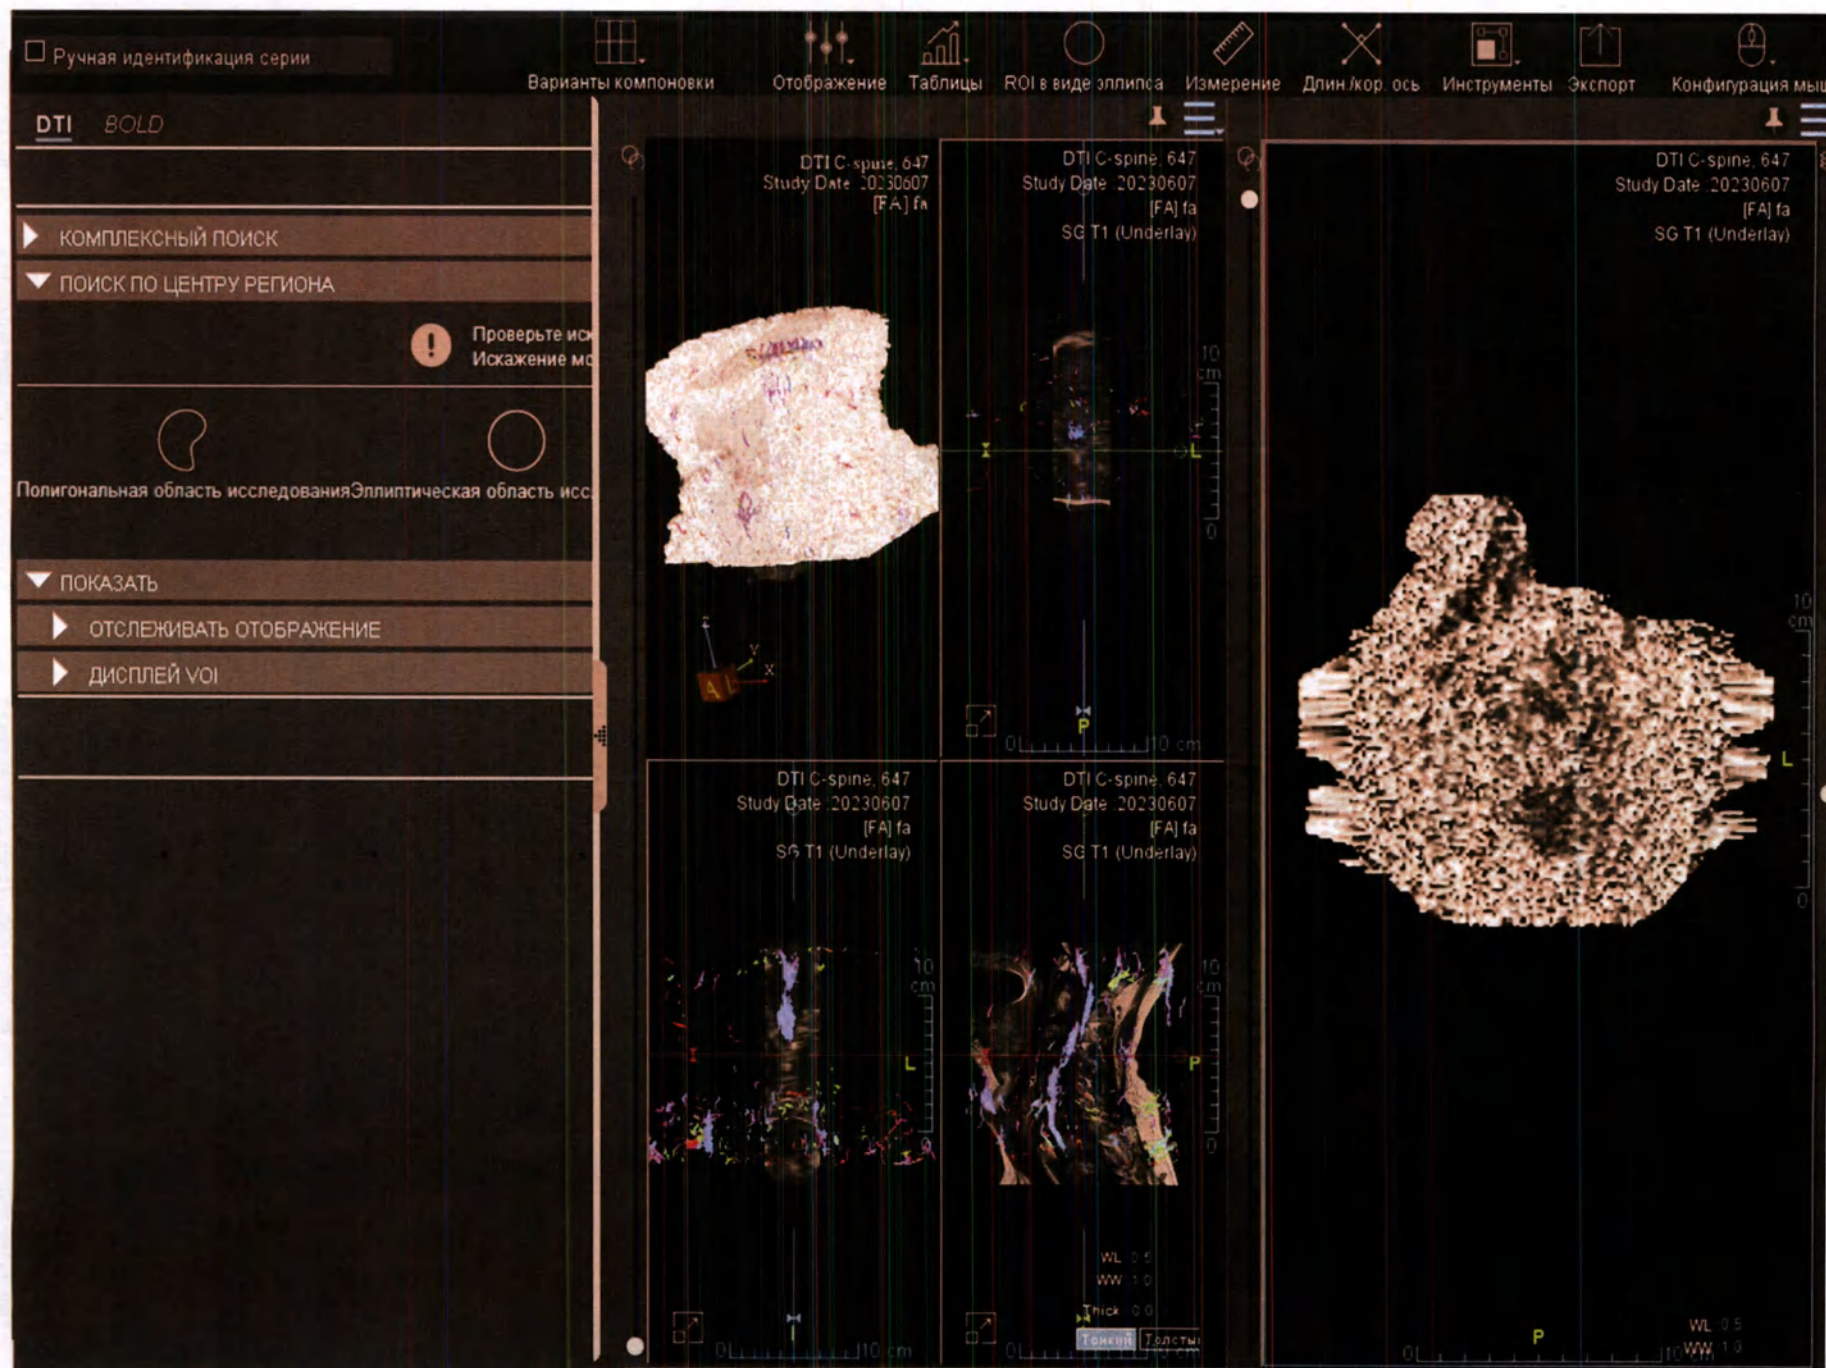

9. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в неврологии (при необходимости) (Head and Neck Expanded)

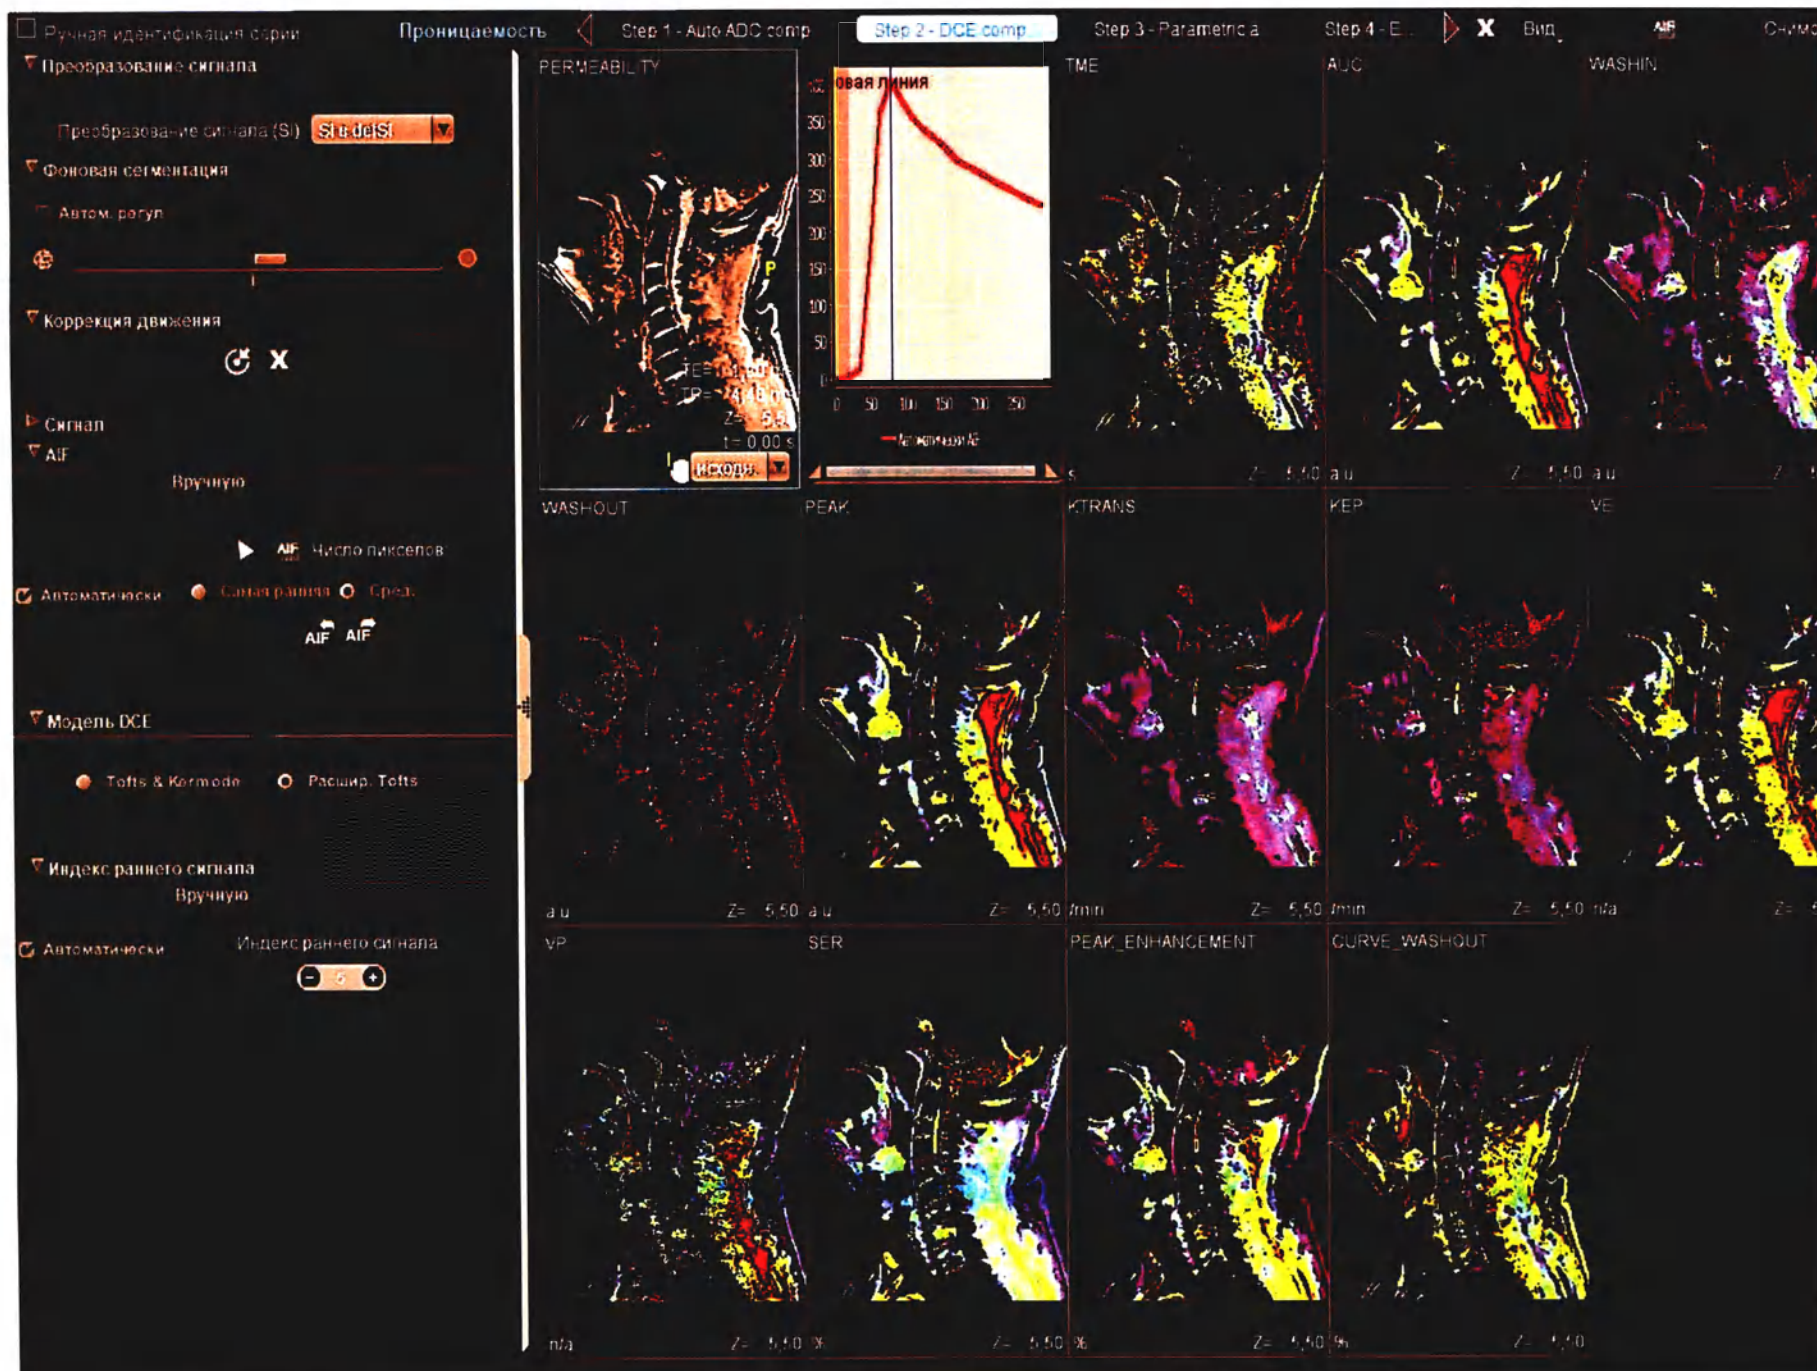

10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Metabolic)



Галерея

Релаксометрия

Коррекция движения

✕

Пространственное сглаживание

↺

Фоновая сегментация

Автом. регул.

0

100

Пороговые значения

Мин = 0 Макс = 40 ✕

Мин = 40 Макс = 80 ✕

EXP PROTOCOL FROM S...

№ серии: 26000

2D/FFE2D

2/3/1

EXP PROTOCOL FROM STD PAS WITH SATS AND 2 NAO

3T

2D/FFE2D

2/3/2

Relaxo T2star Liver 3T Galan, OMVTD/A_QR*1wK4o

ID исслед: КК_

2016 авг 30 15 51 28

катушка: BDY SPN

1 = 220,837

Поле обз.: 35,28x35,00 см

MAcqu: 256x192

MRRecon: 508x512

разрешение: 0,7x0,7/7

TE: 2,3 мс

TR: 25,8 мс

FA: 20

ETL: 1

BW: 977 Гц/пикс

NAO: 2

Длит сканир: 0.16

П

Центр окна: 375/Шир окна: 751

EXP PROTOCOL FROM STD PAS WITH SATS AND 2 NAO

3T

2D/FFE2D

2/3/2

Relaxo T2star Liver 3T Galan, OMVTD/A_QR*1wK4o

ID исслед: КК_

2016 авг 30 15 51 28

катушка: BDY SPN

2 = 15,678

Поле обз.: 35,28x35,00 см

MAcqu: 256x192

MRRecon: 508x512

разрешение: 0,7x0,7/7

TE: 4,6 мс

TR: 25,8 мс

FA: 20

ETL: 1

BW: 977 Гц/пикс

NAO: 2

Длит сканир: 0.16

П

Центр окна: 375/Шир окна: 751

T2_STAR_MAP () [3 imag

1/3

3T

T2_STAR_MAP

Relaxo T2star Liver 3T Galan, OMVTD/A_QR*1wK4o

ID исслед: КК_

2023 янв 29 00 44 21

2 = 15,678

Поле обз.: 35,28x35,00 см

MAcqu: 256x192

MRRecon: 508x512

разрешение: 0,7x0,7/7

ms

П

Центр окна: 17/Шир окна: 34

threshold () [6 images] (M

3/3/1

EXP

Threshold [0.40] on T2_STAR_M

Relaxo T2star Liver 3T Galan, OMVTD/A_QR*1w

ID исслед: КК_

2023 янв 29 00 44 21

2 = 15,678

Поле обз.: 35,28x35,00 см

MAcqu: 256x192

MRRecon: 508x512

разрешение: 0,7x0,7/7

ms

П

Центр окна: 17/Шир окна: 34

Длин./корот. оси

Други

Исслед. обл.

Линии

Угл

Сред

Медиана

1

220,837

216,847

2


15,678

14,587


10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (IVIM)




10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Breast Expanded)

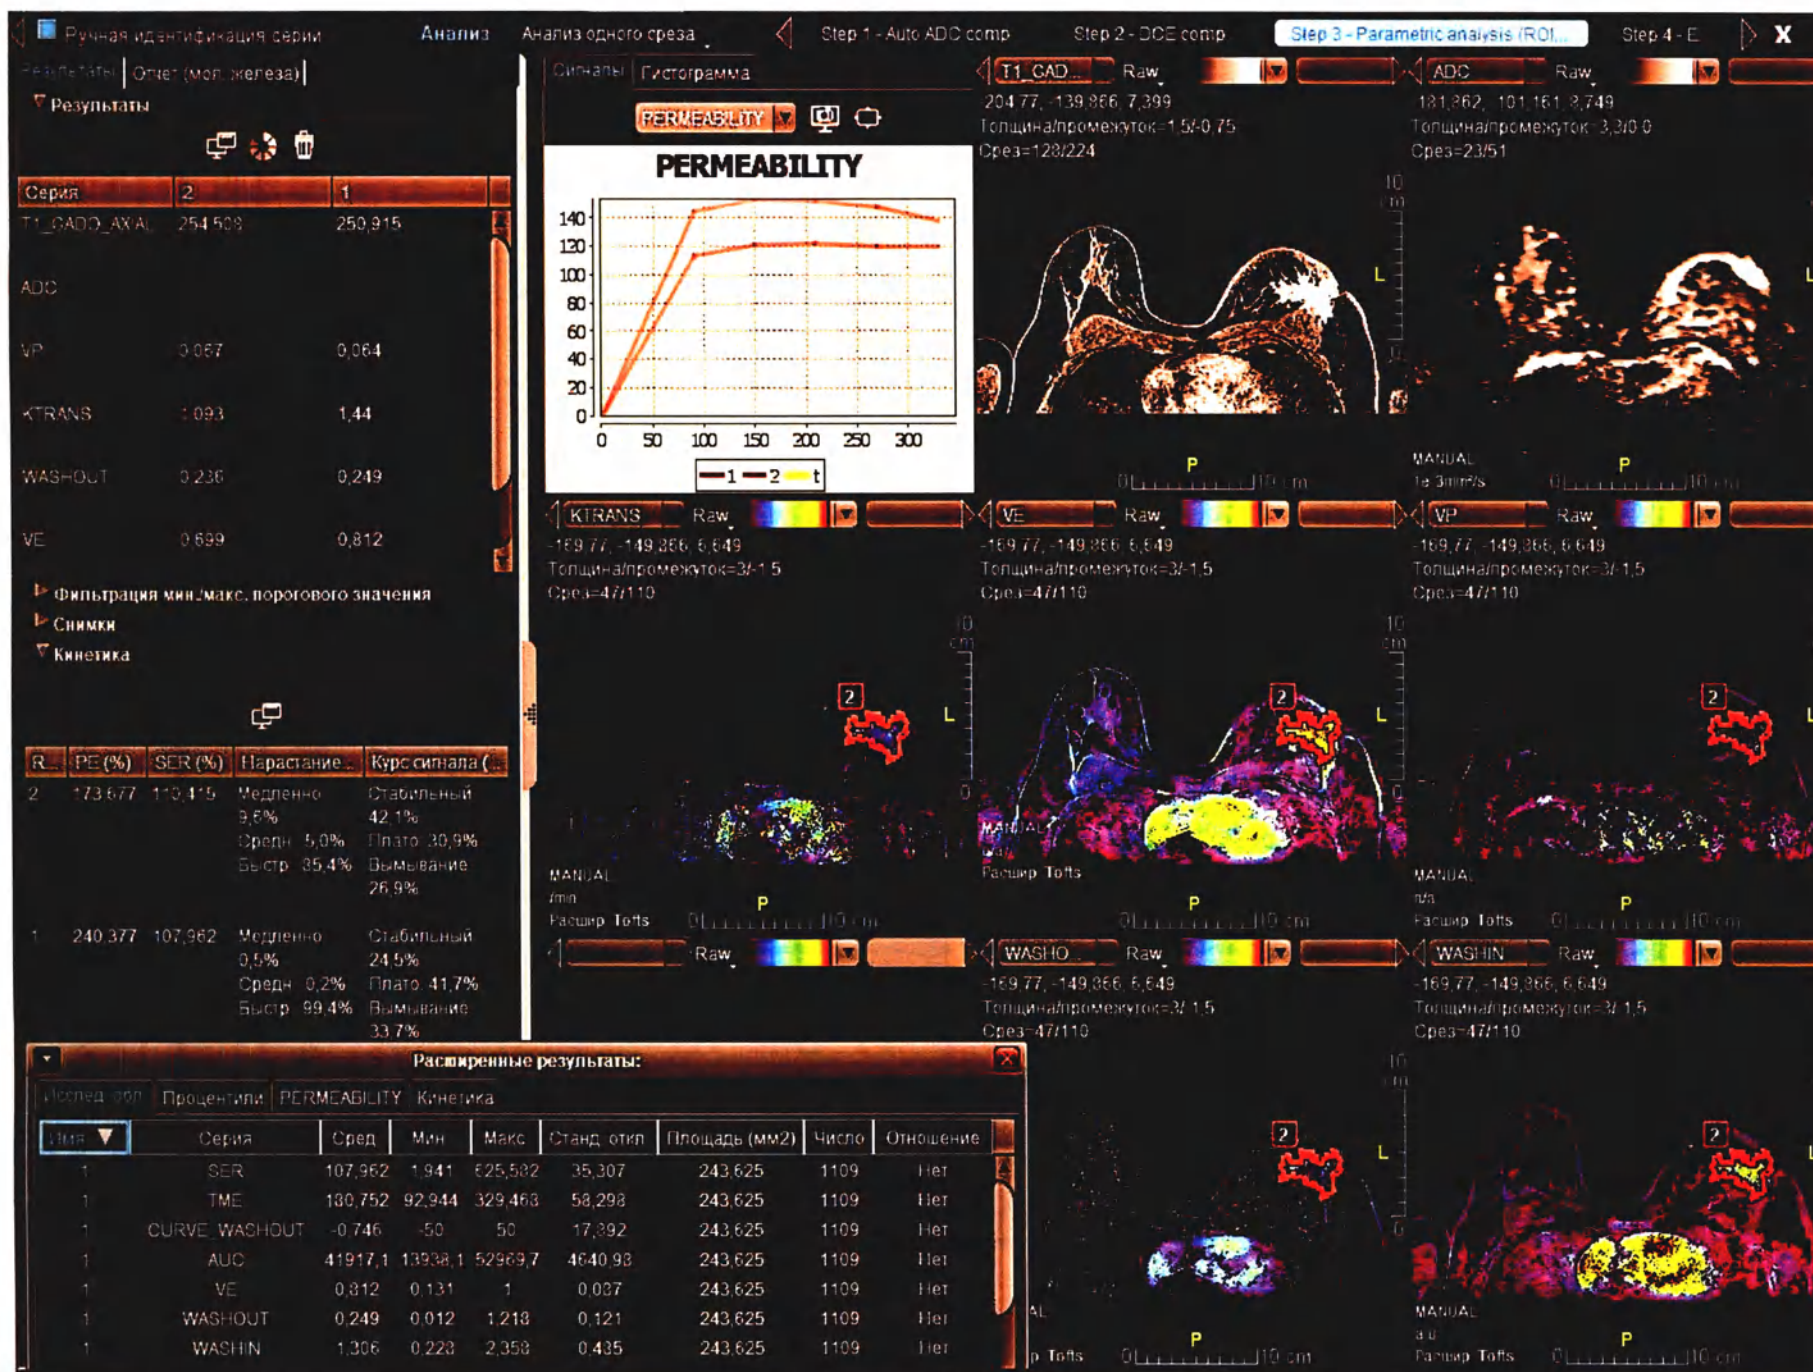


10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Prostate Expanded)

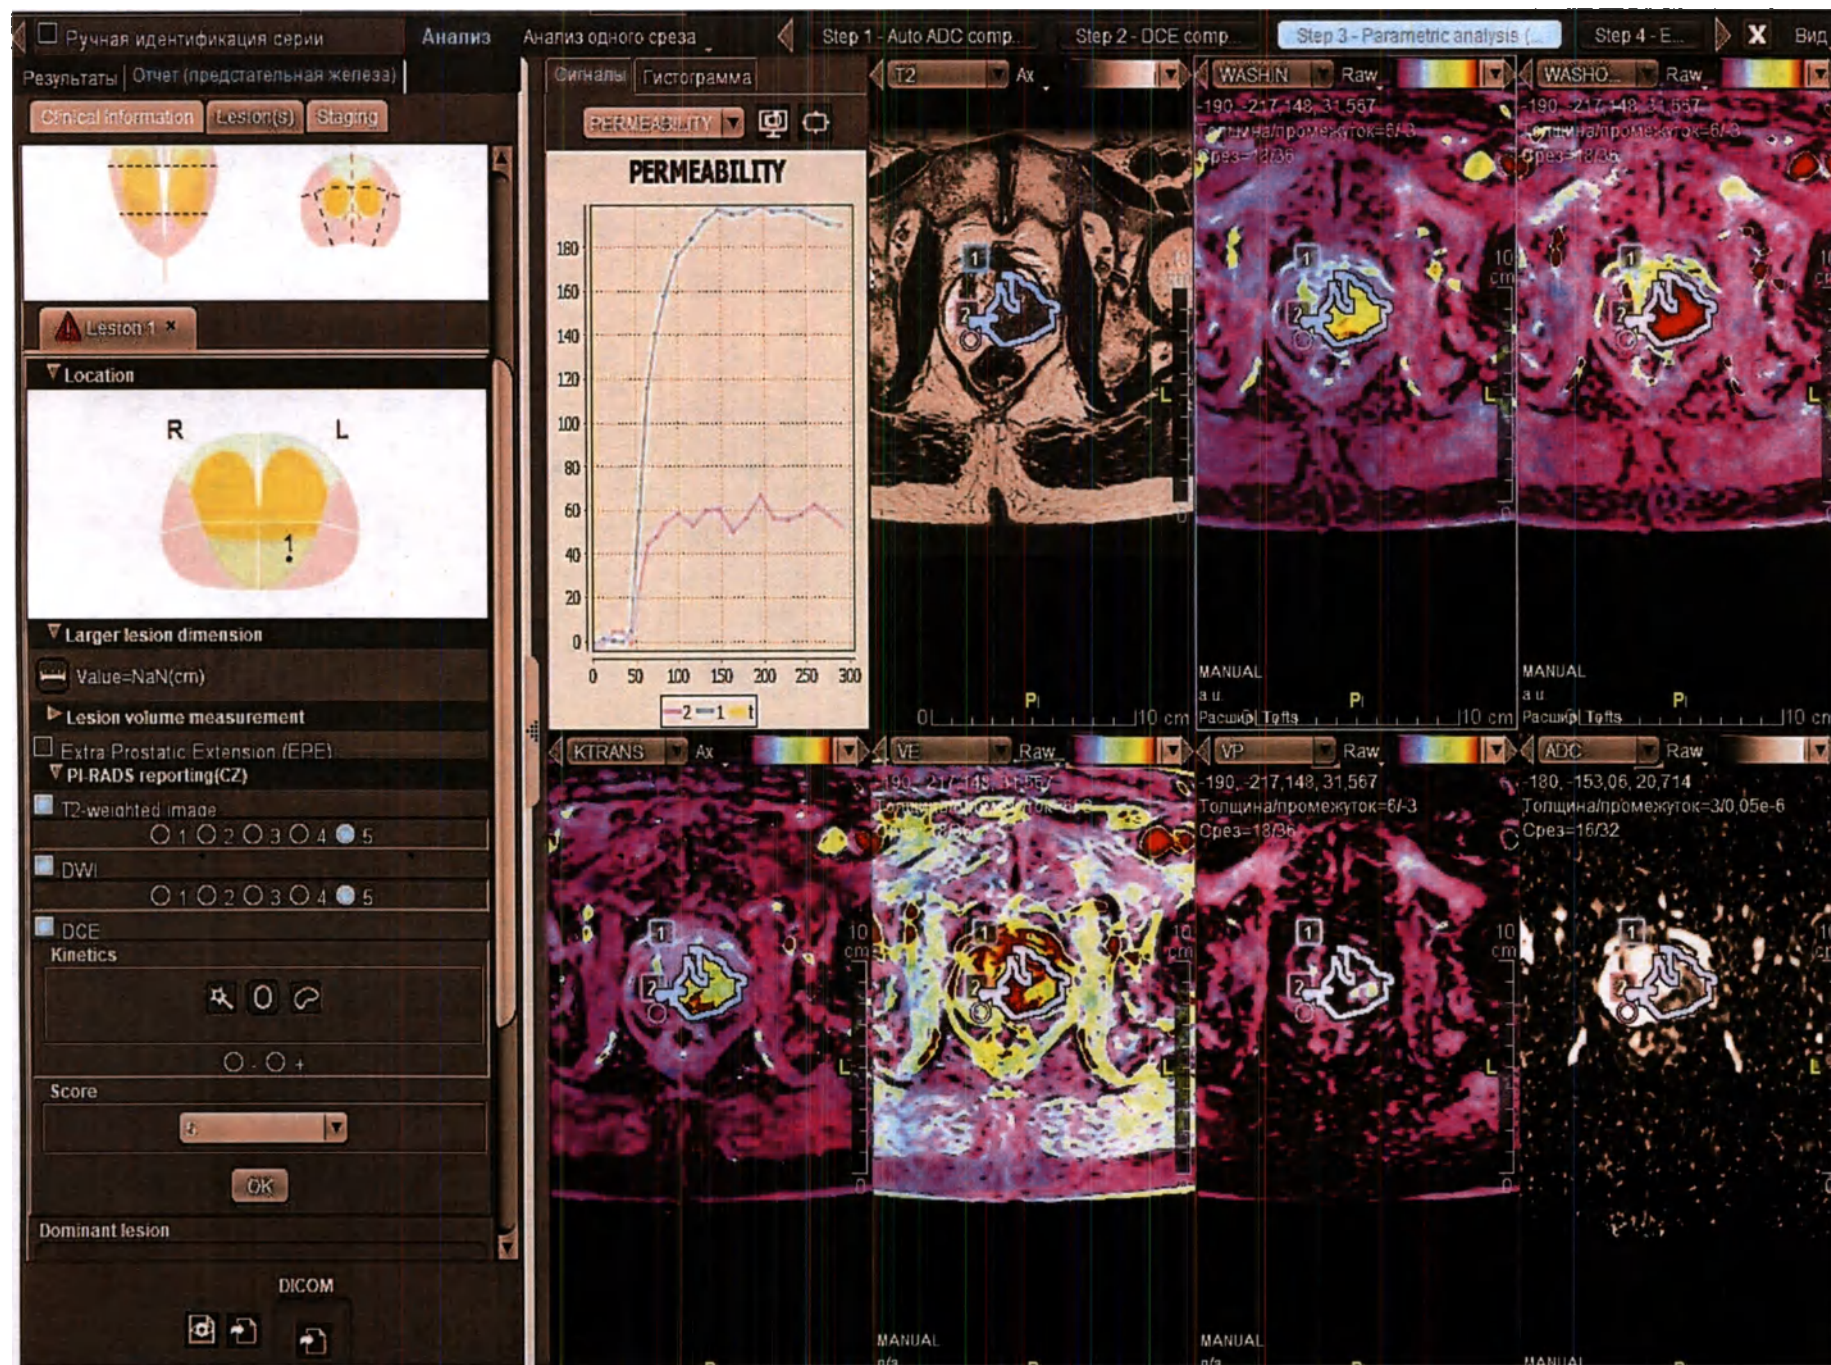


10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Female Pelvis)

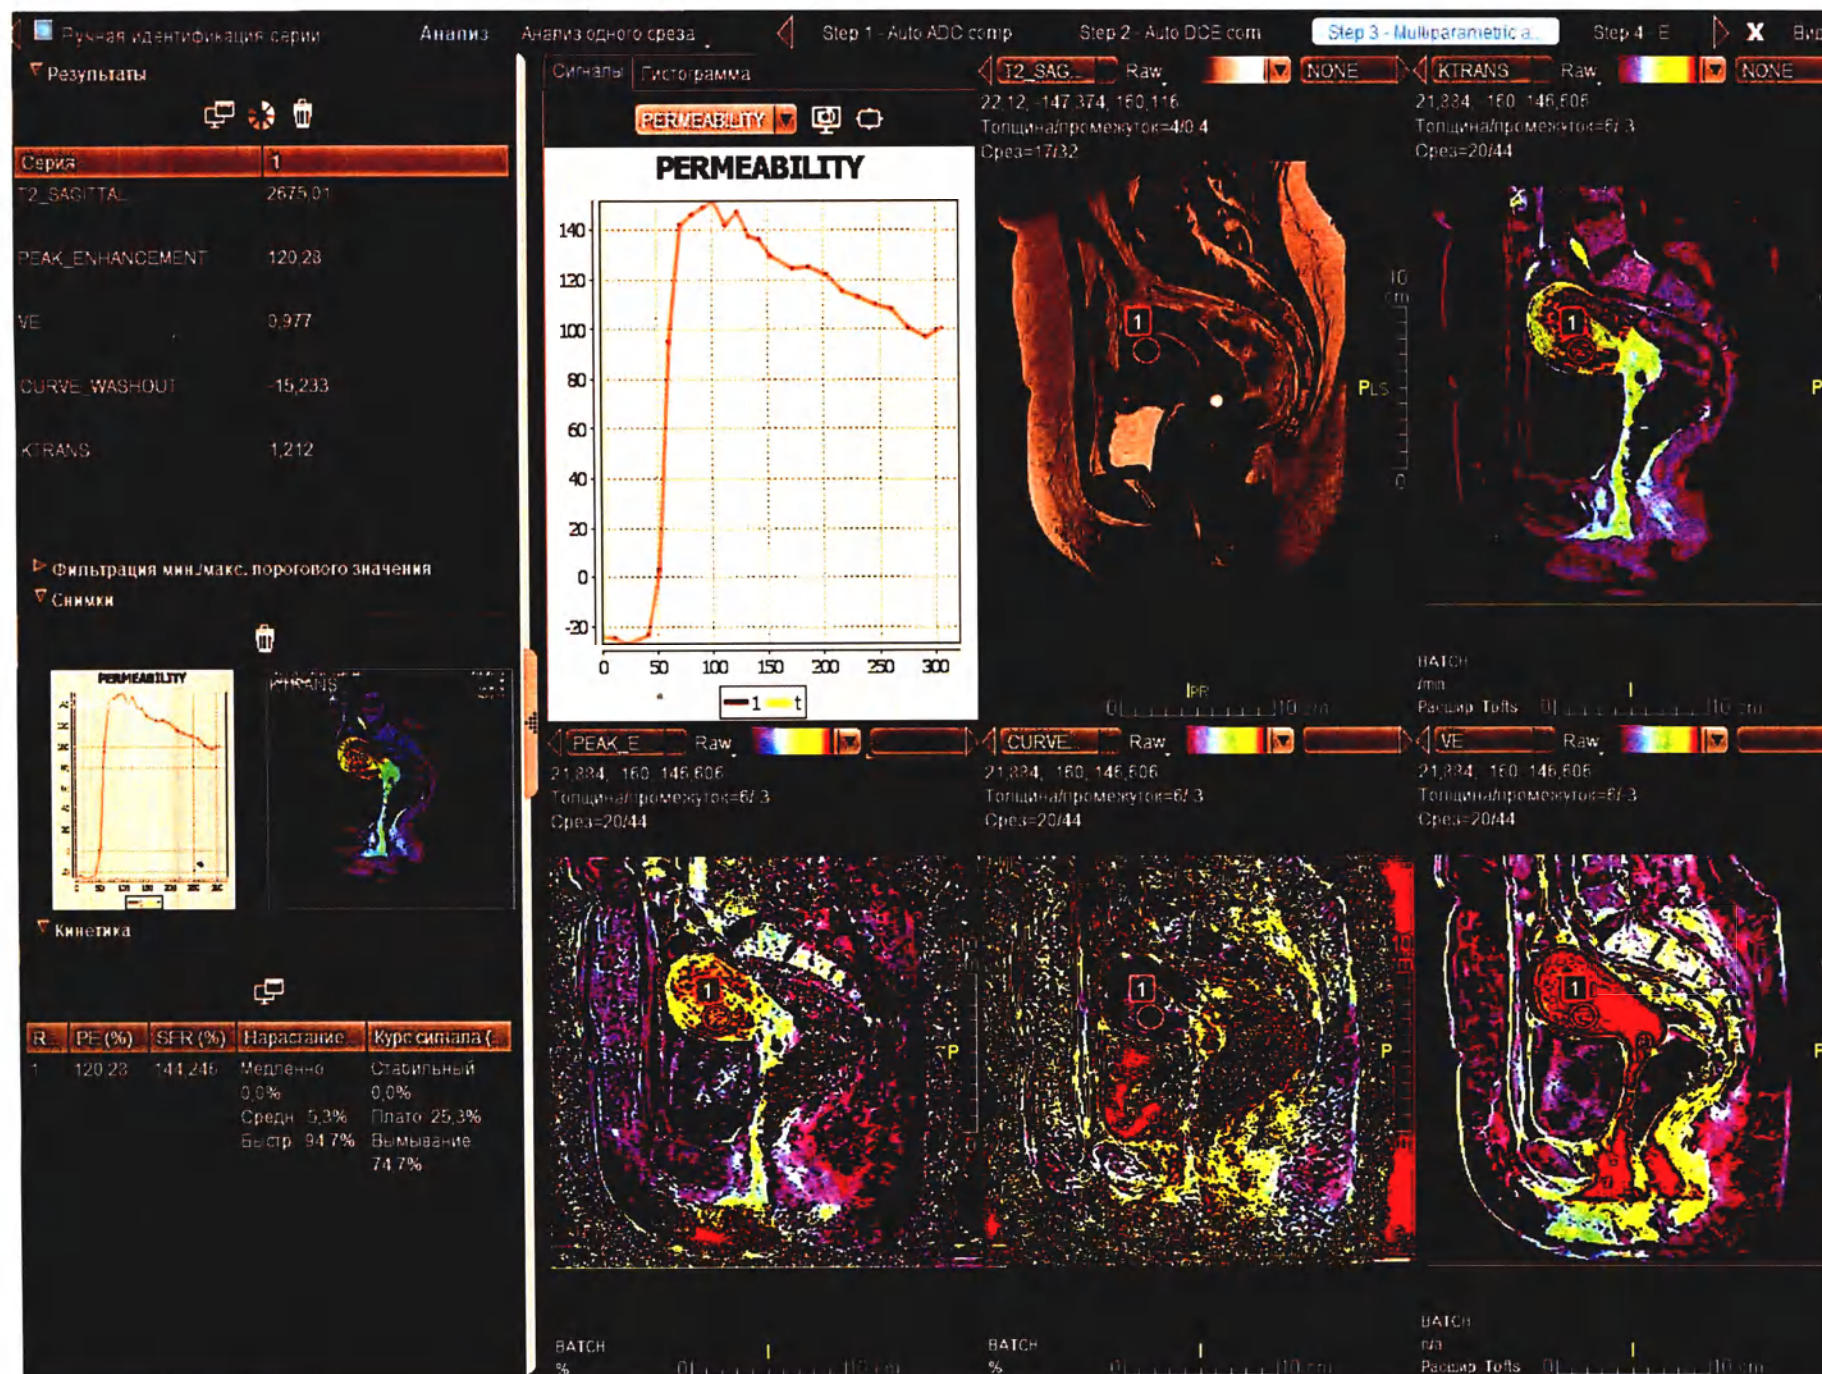


10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Permeability option)

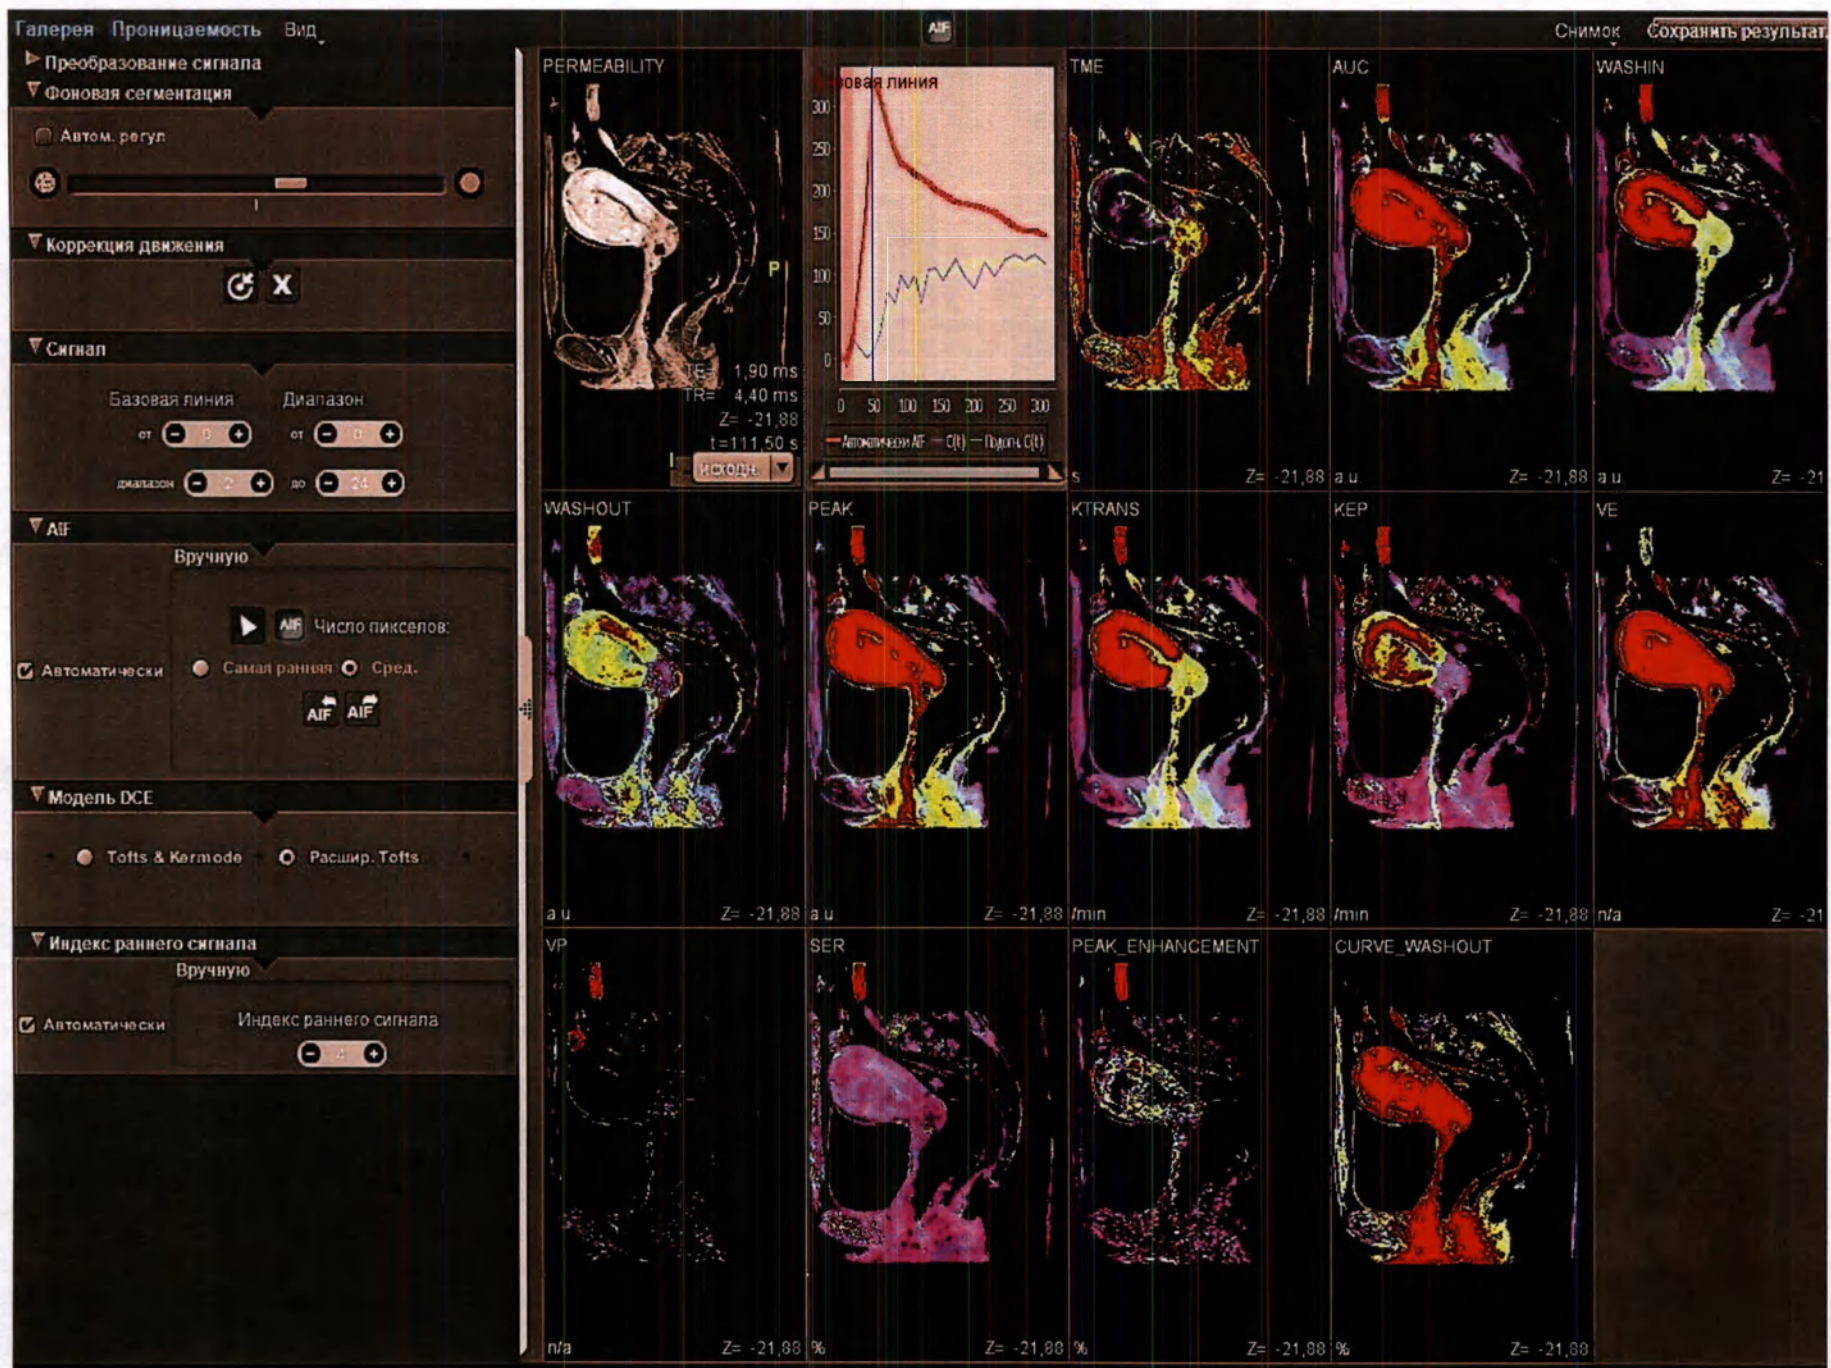


10. Программный пакет для экспертной МР-диагностики внутренних органов (при необходимости) (Rectum Streamlined)

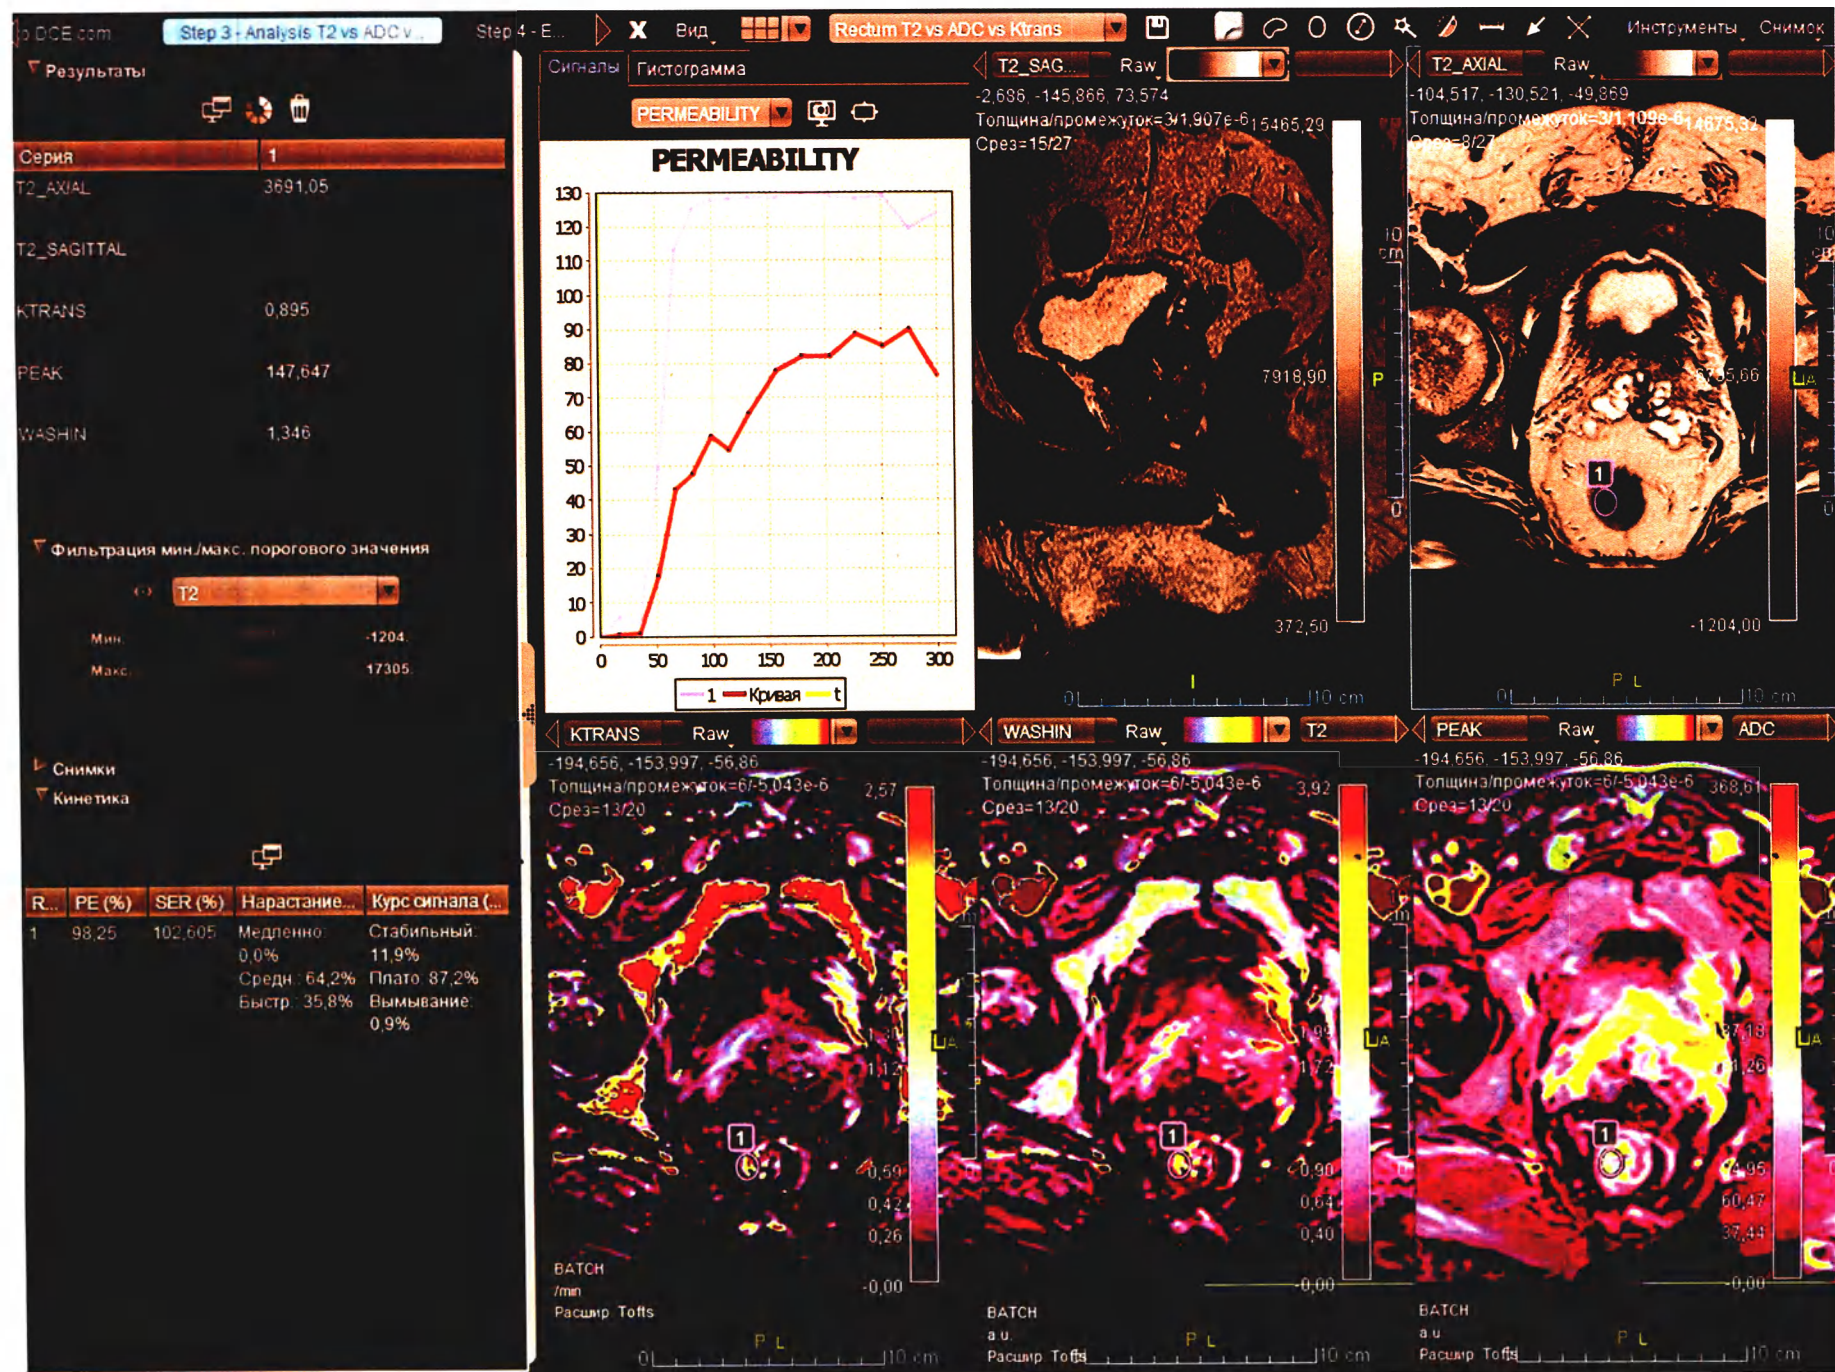


11. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в ортопедии (при необходимости) (Relaxometry)

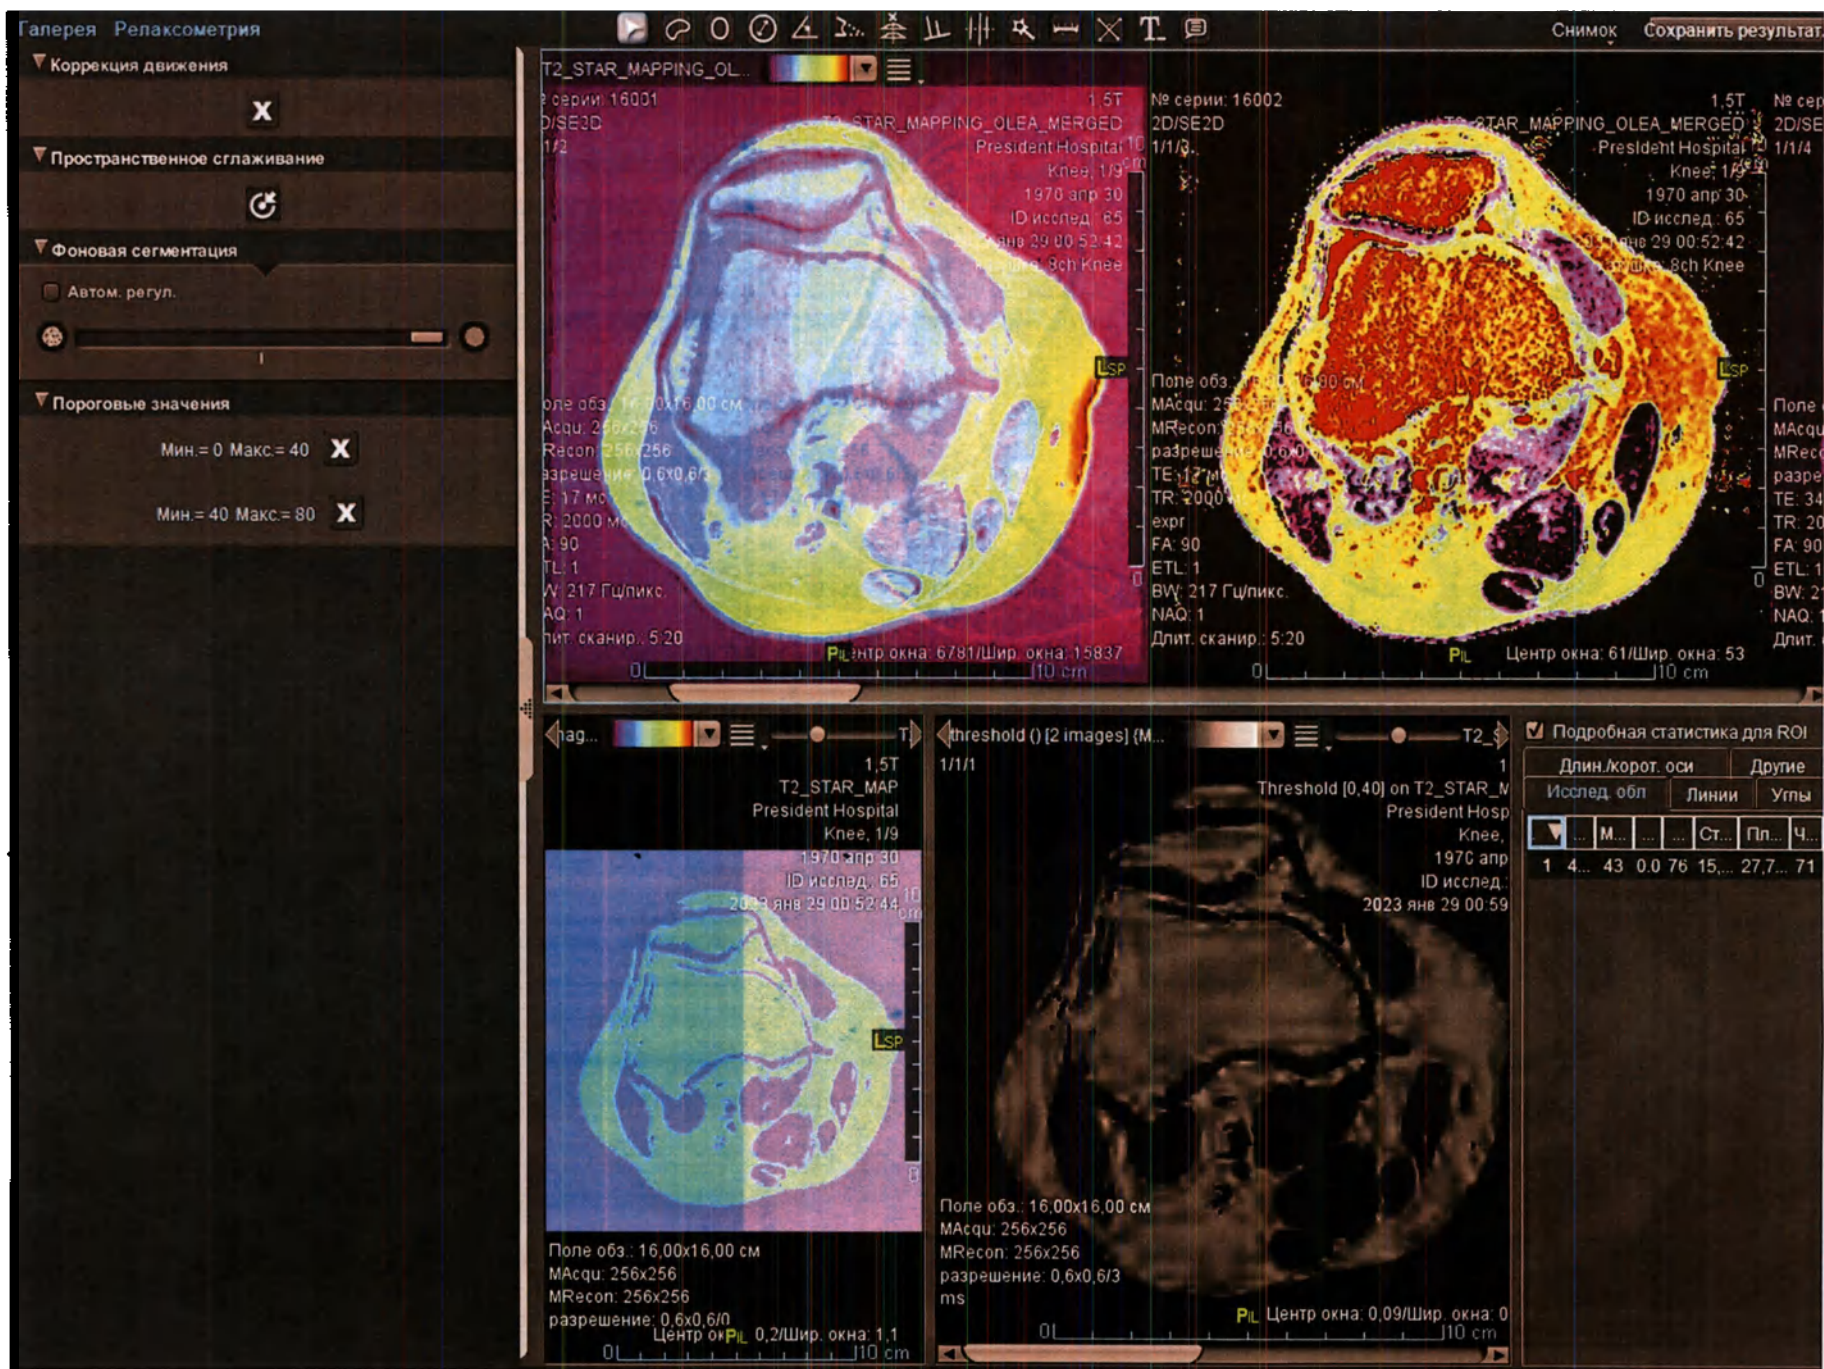


11. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в ортопедии (при необходимости) (MSK Cartilage)

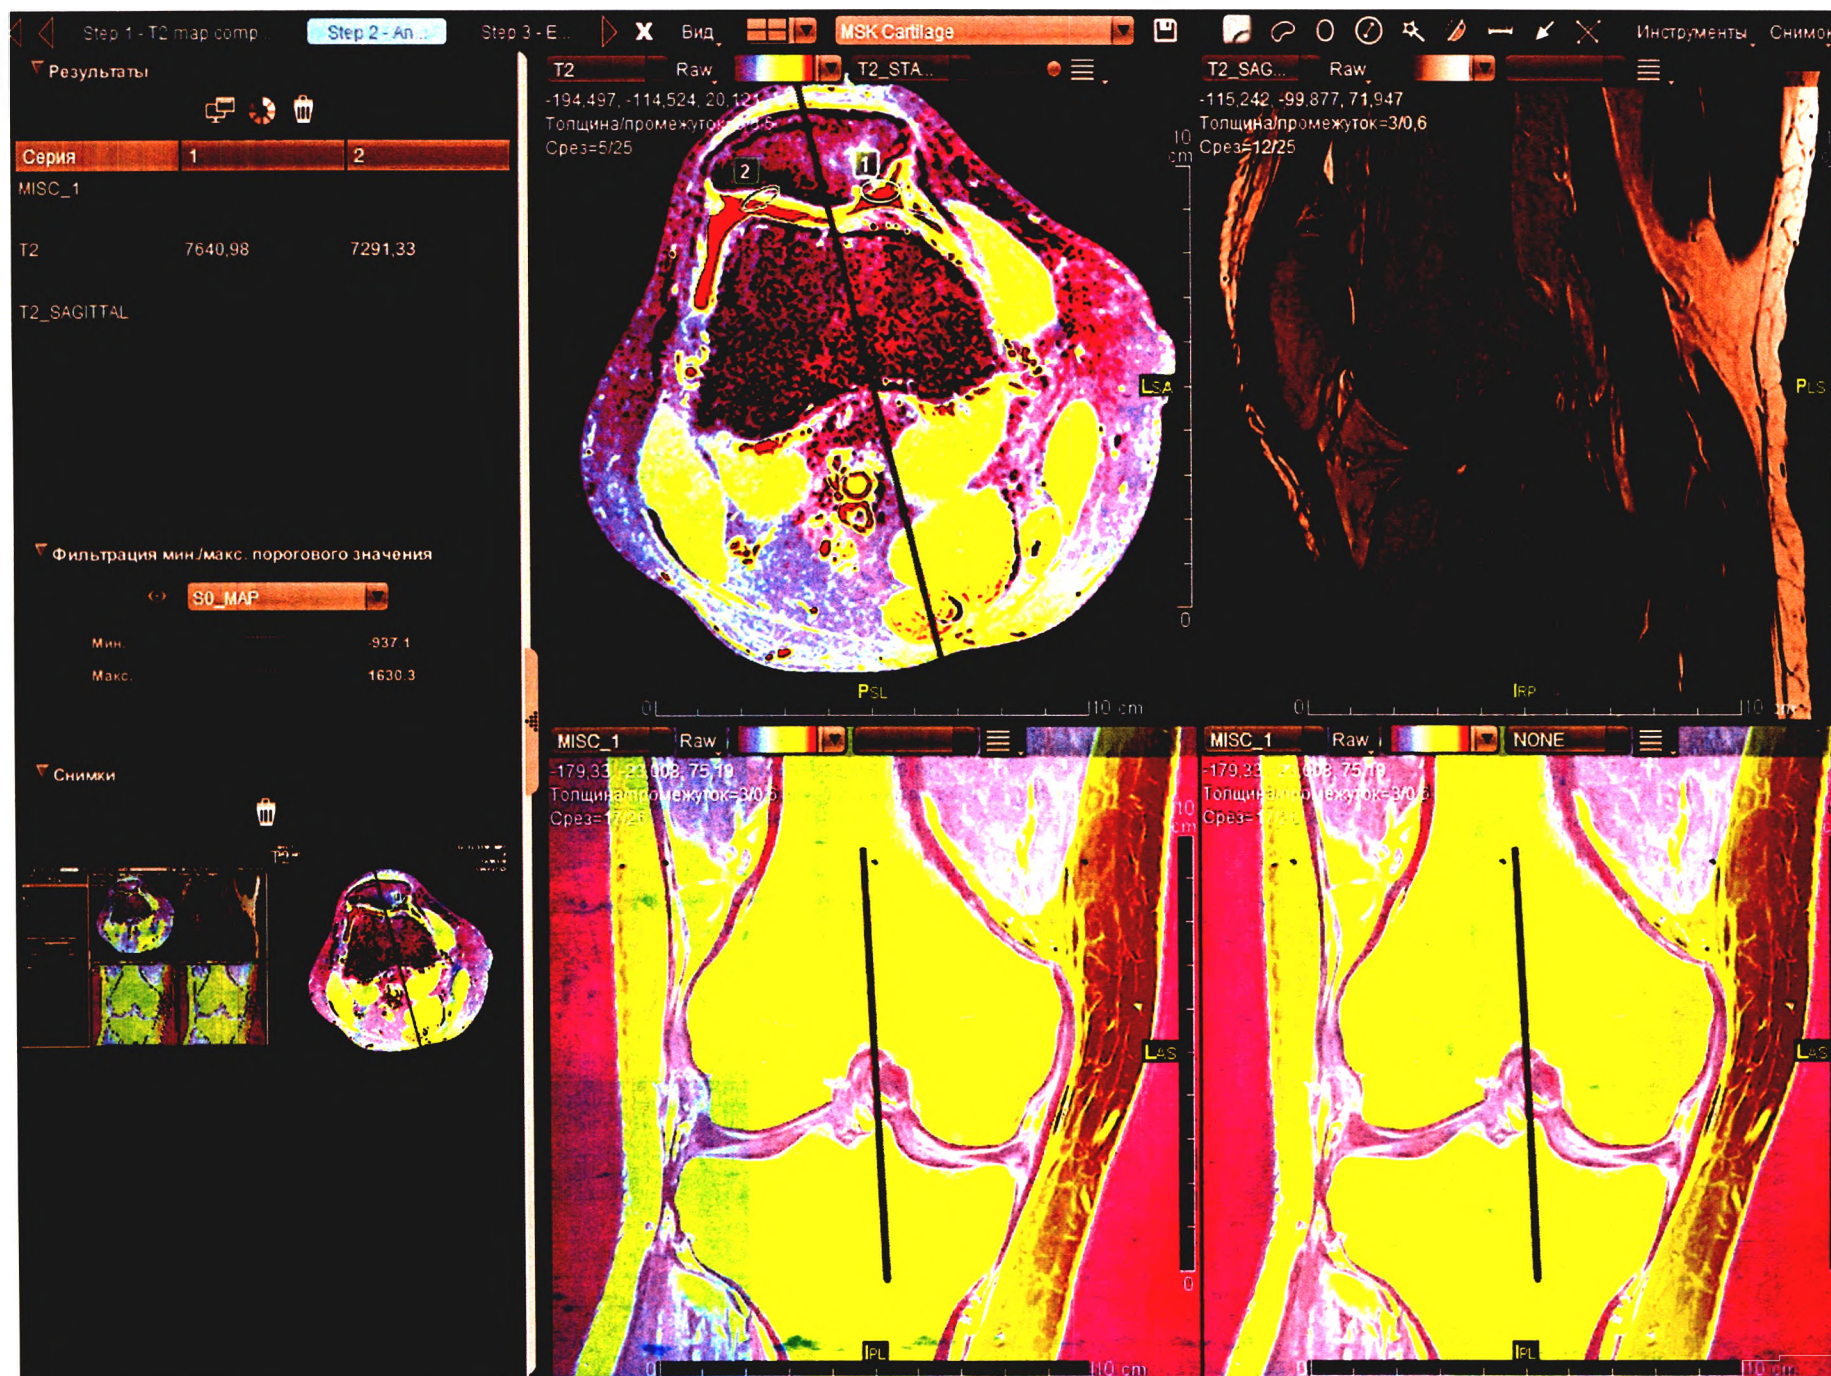


12. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в кардиологии (при необходимости) (MR Wall Motion Tracking)

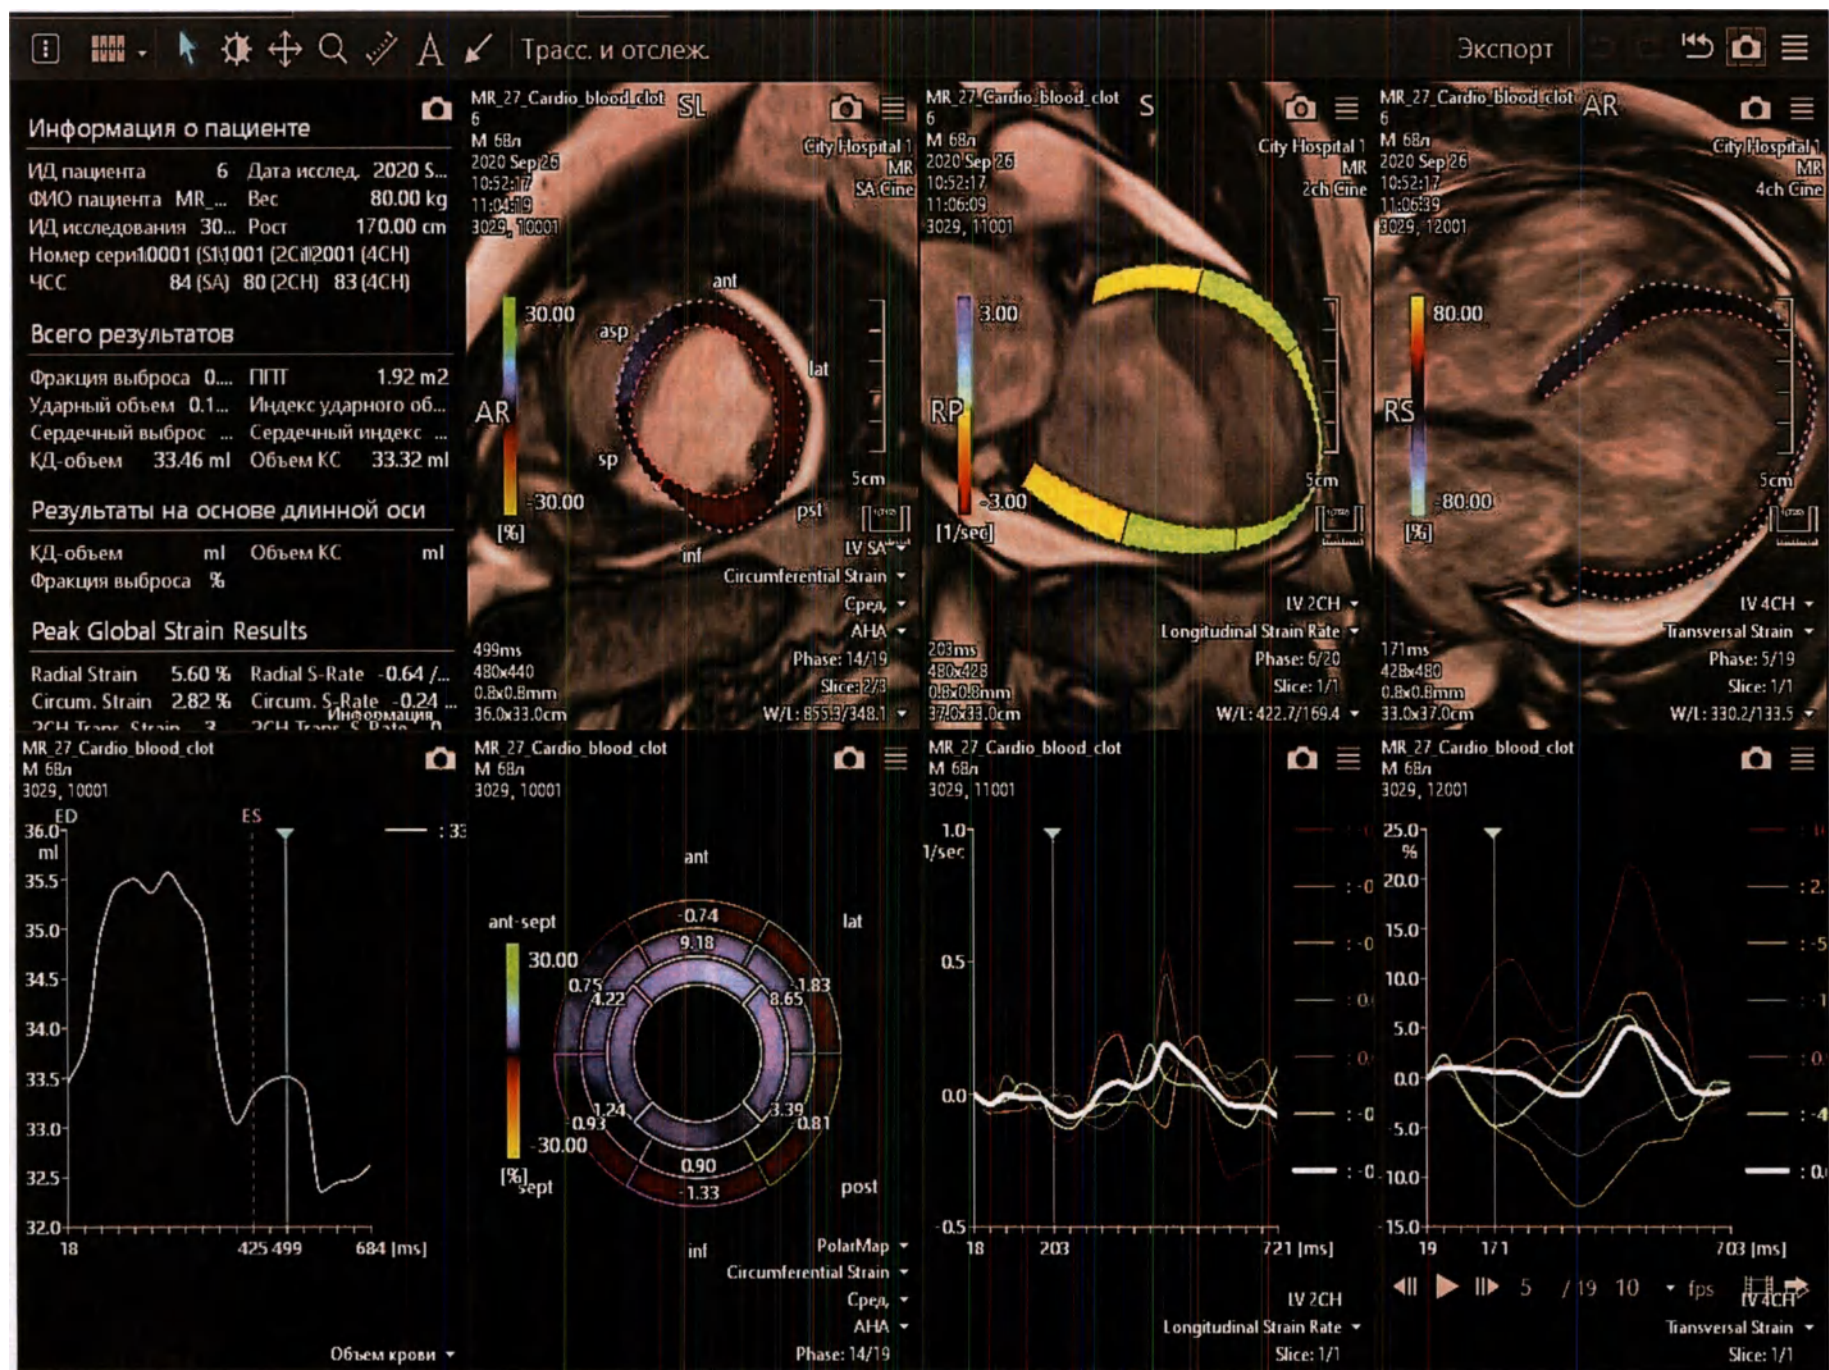


12. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в кардиологии (при необходимости) (MR Coronary Tracking)

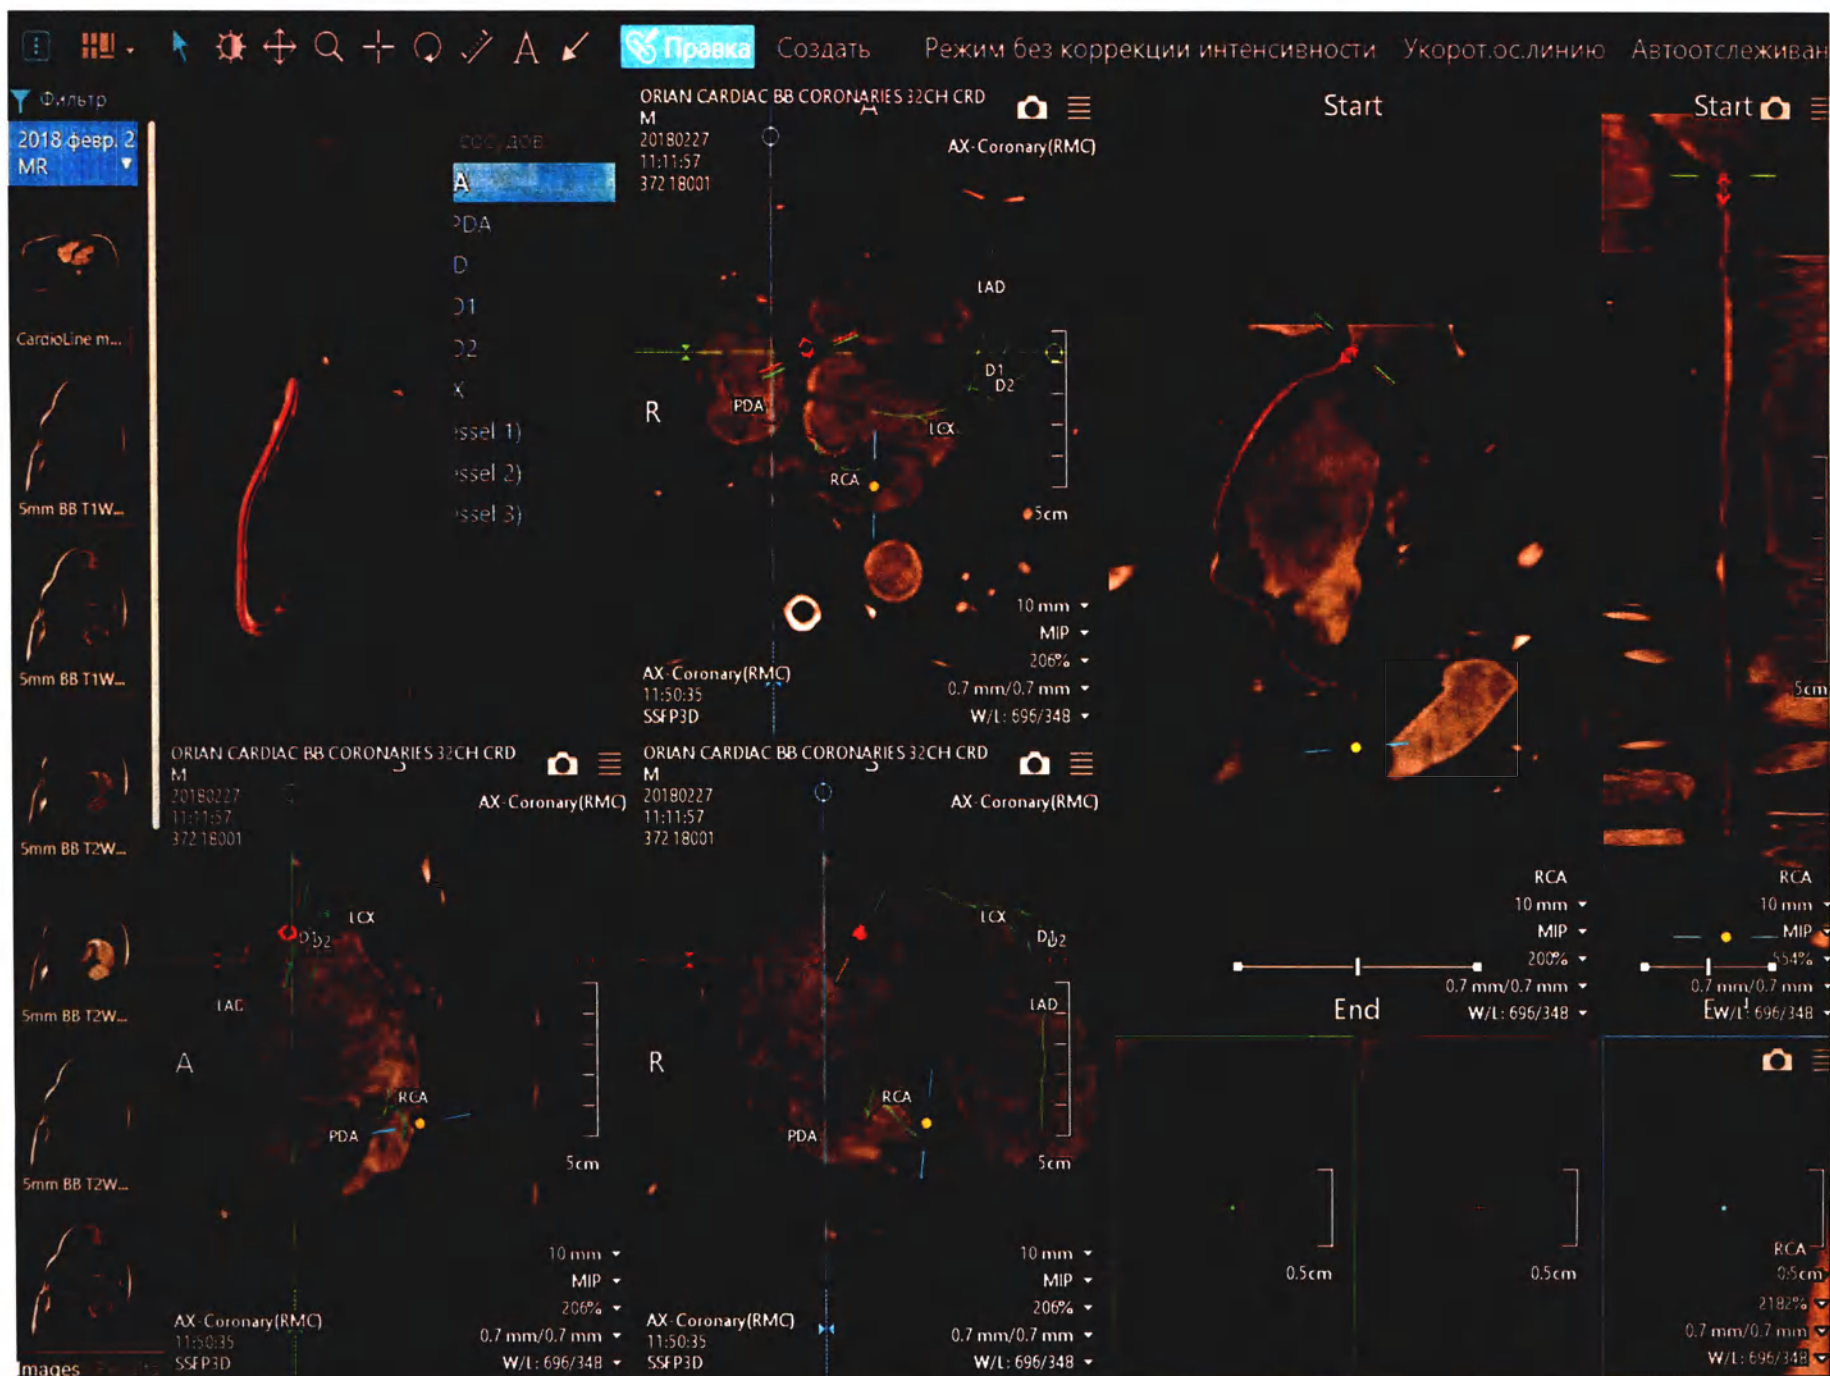


12. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в кардиологии (при необходимости) (MR Wall Motion Tracking Multi Chamber)

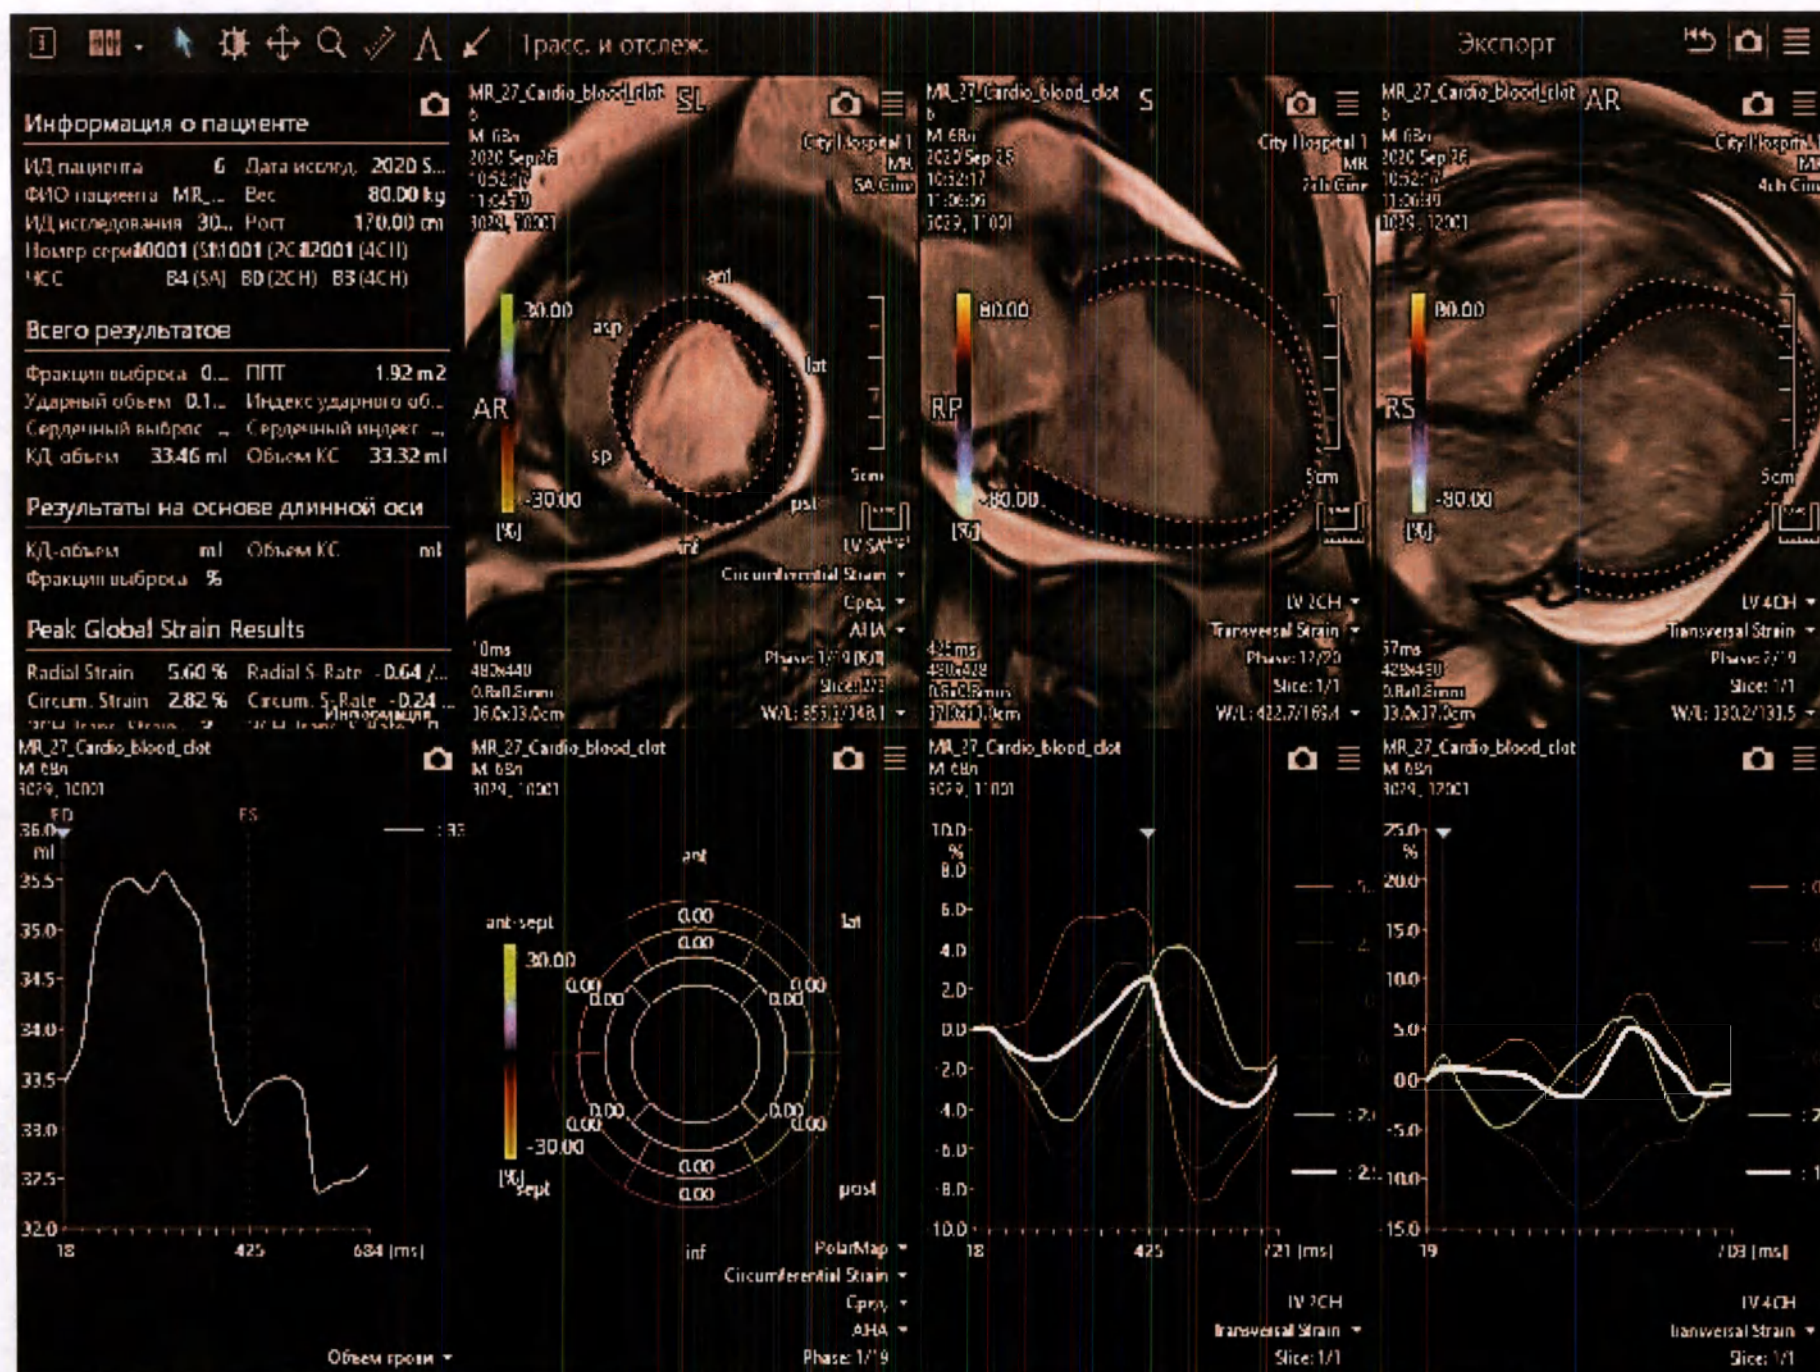


12. Программный пакет для экспертной МР-диагностики в кардиологии (при необходимости) (Medis Suite Cardiovascular MR (CVMR))

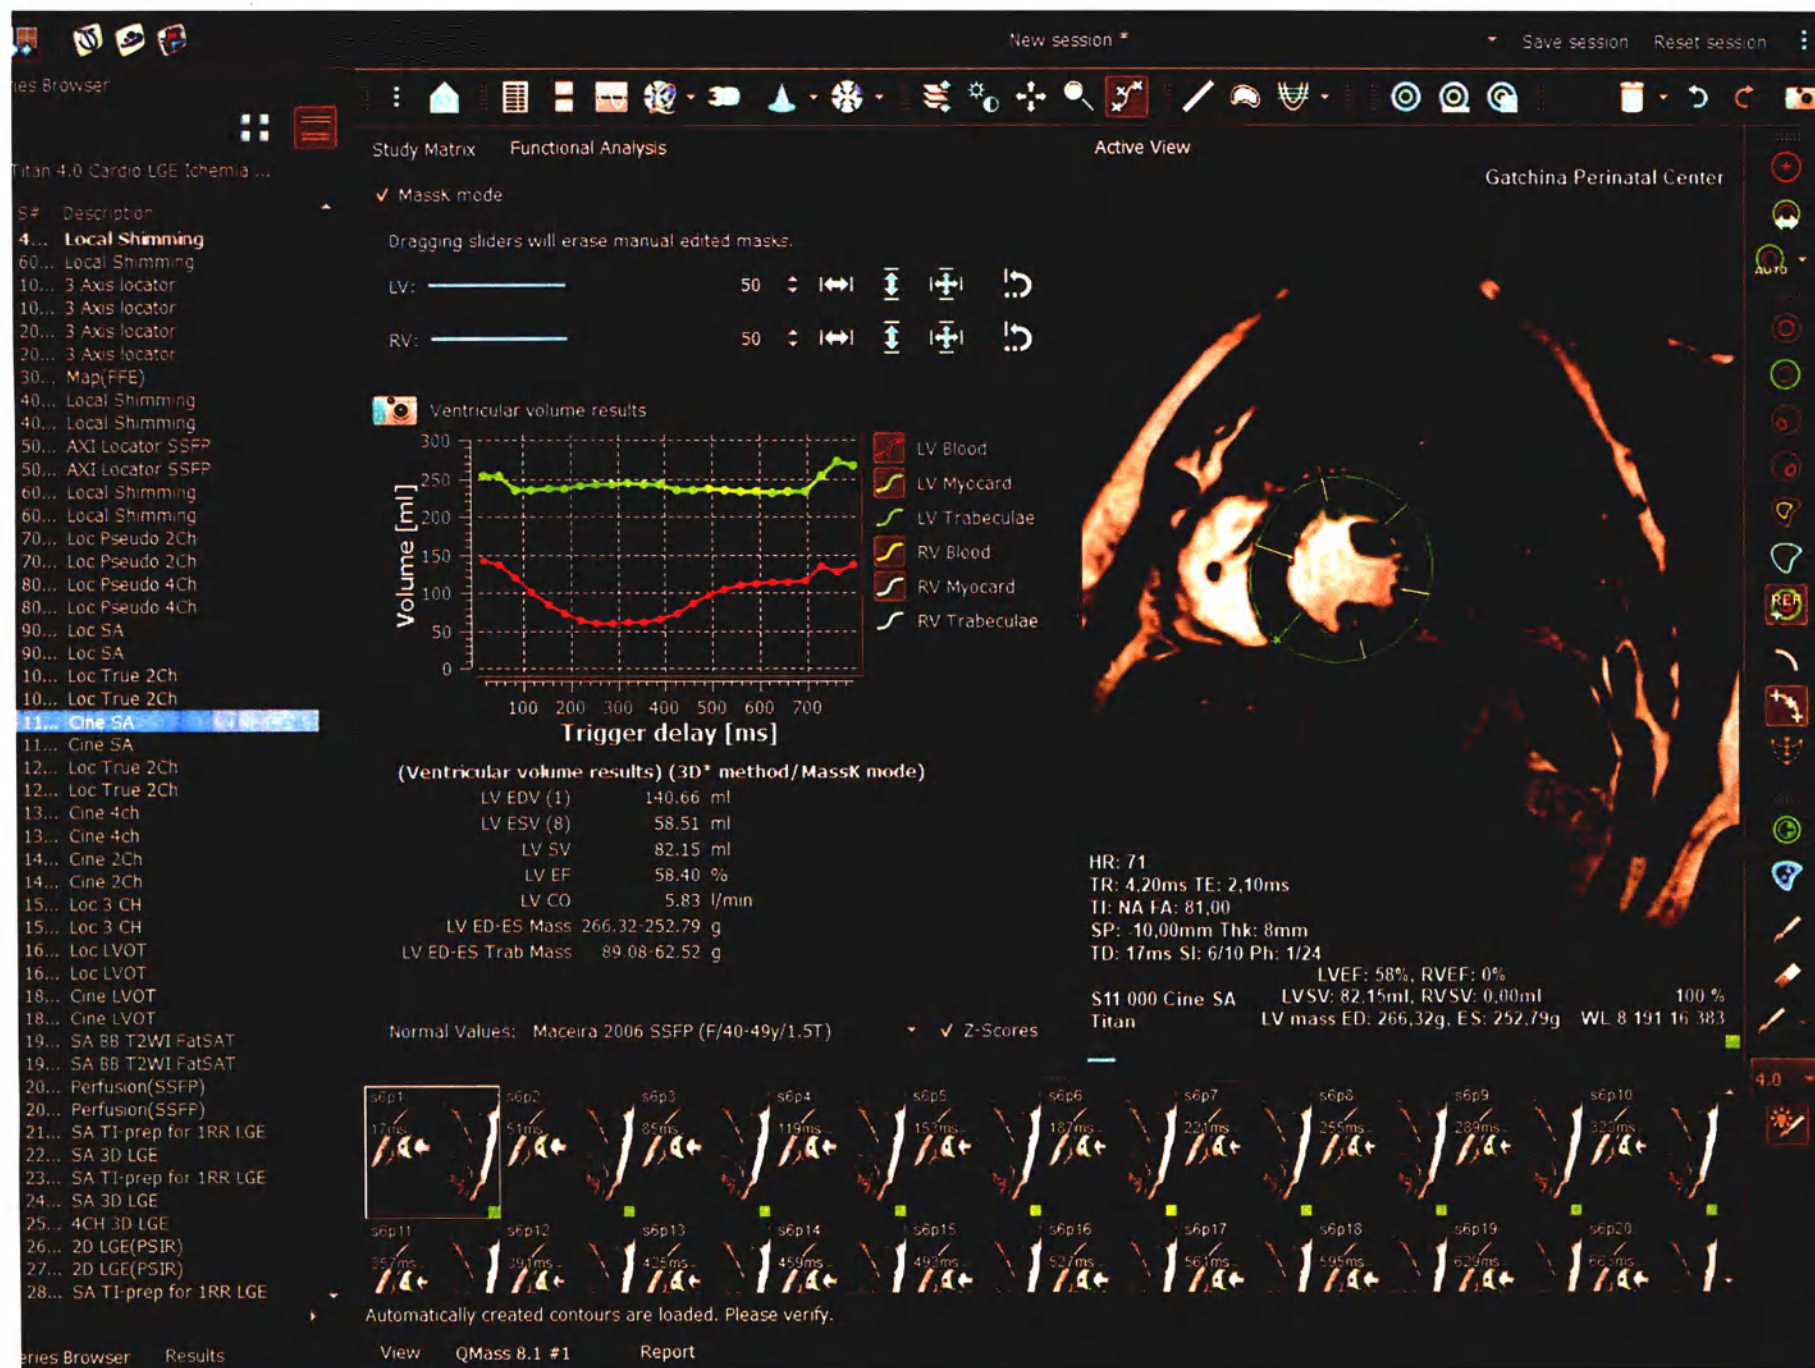


13. Приложение для трехмерного анализа ангиографических изображений (при необходимости)

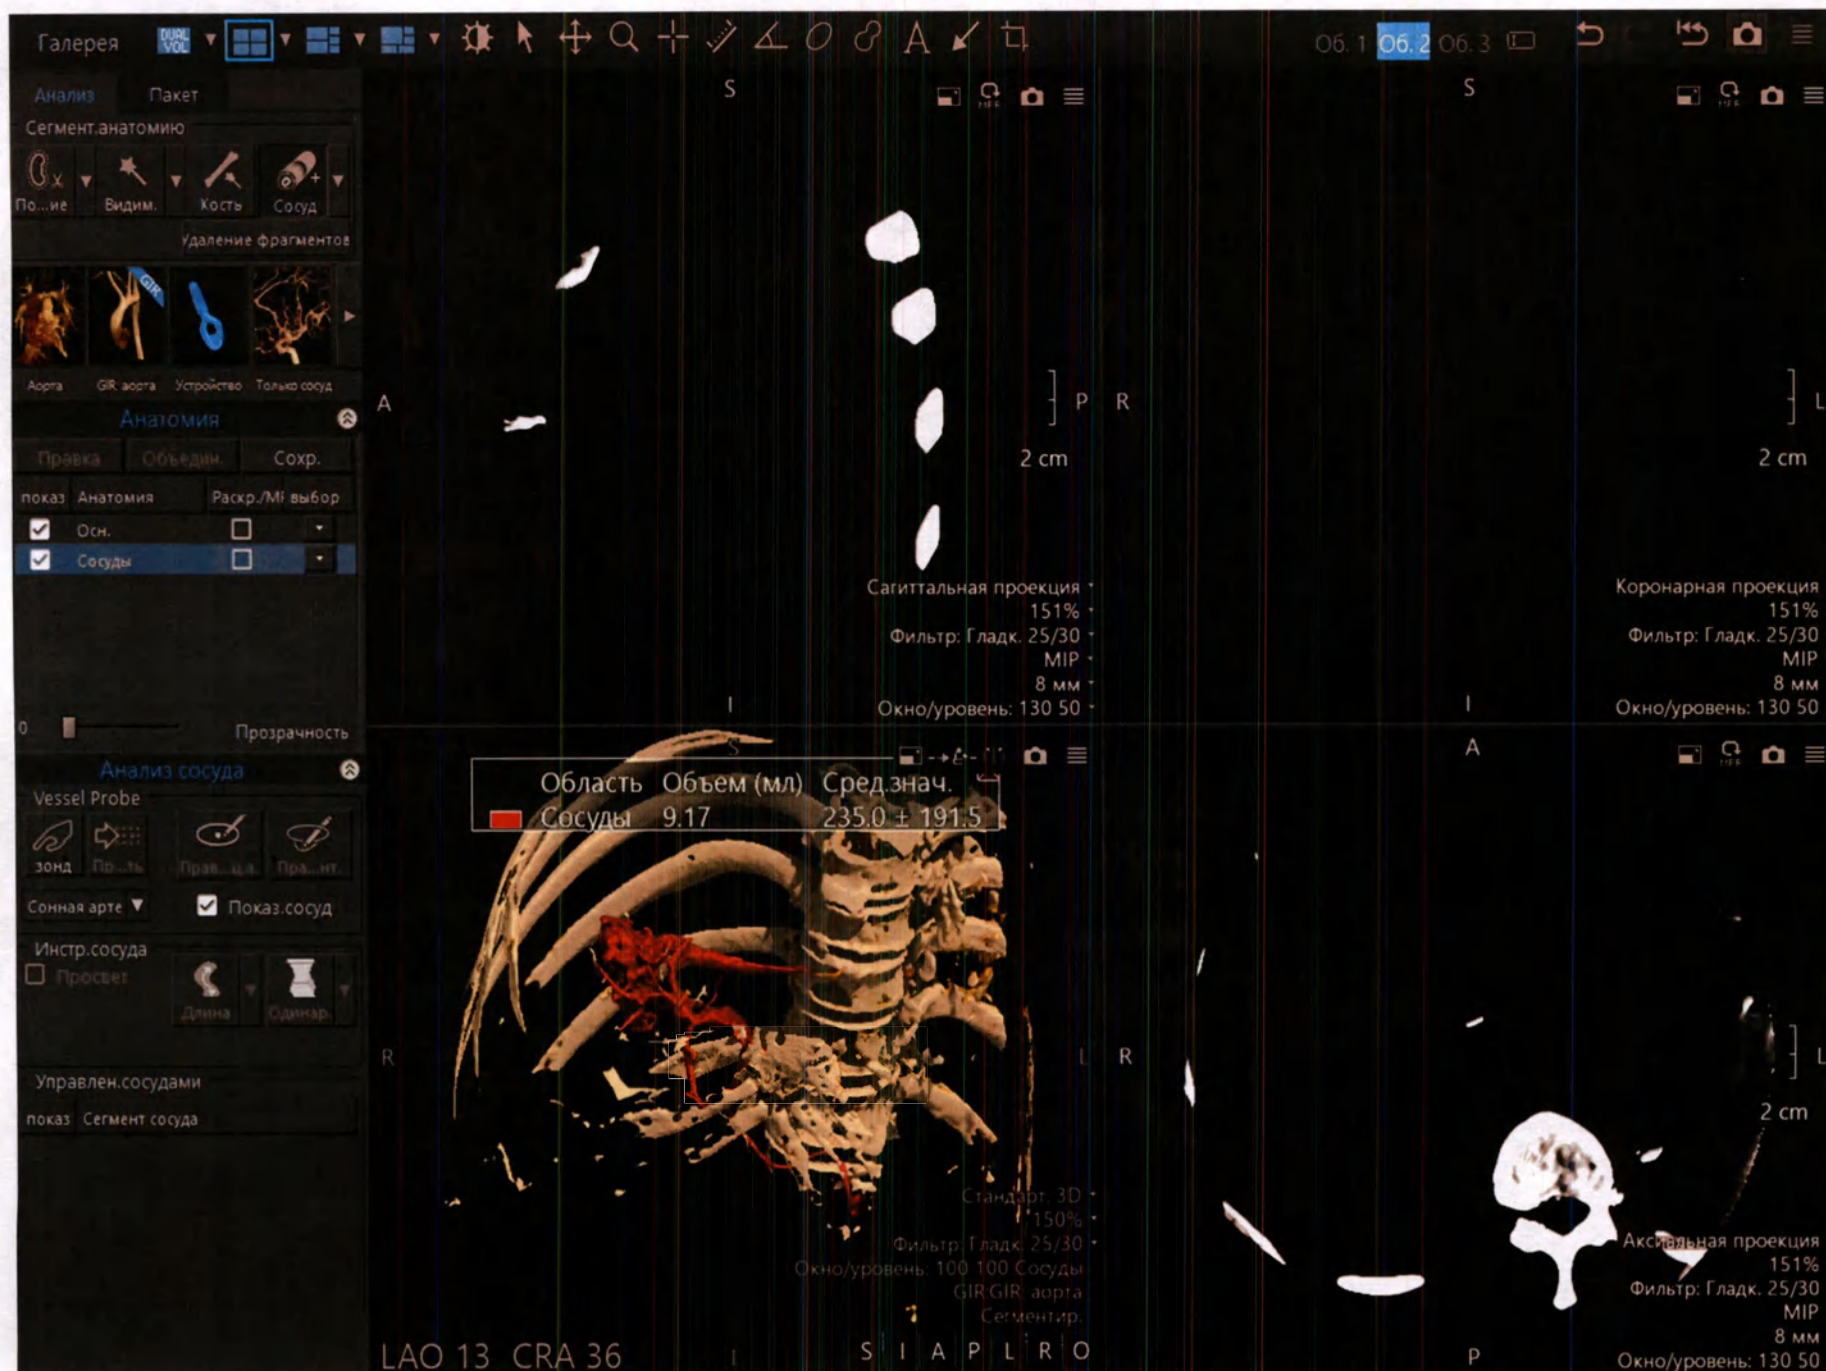


14. Приложение для анализа аневризмы сосуда головного мозга (при необходимости)

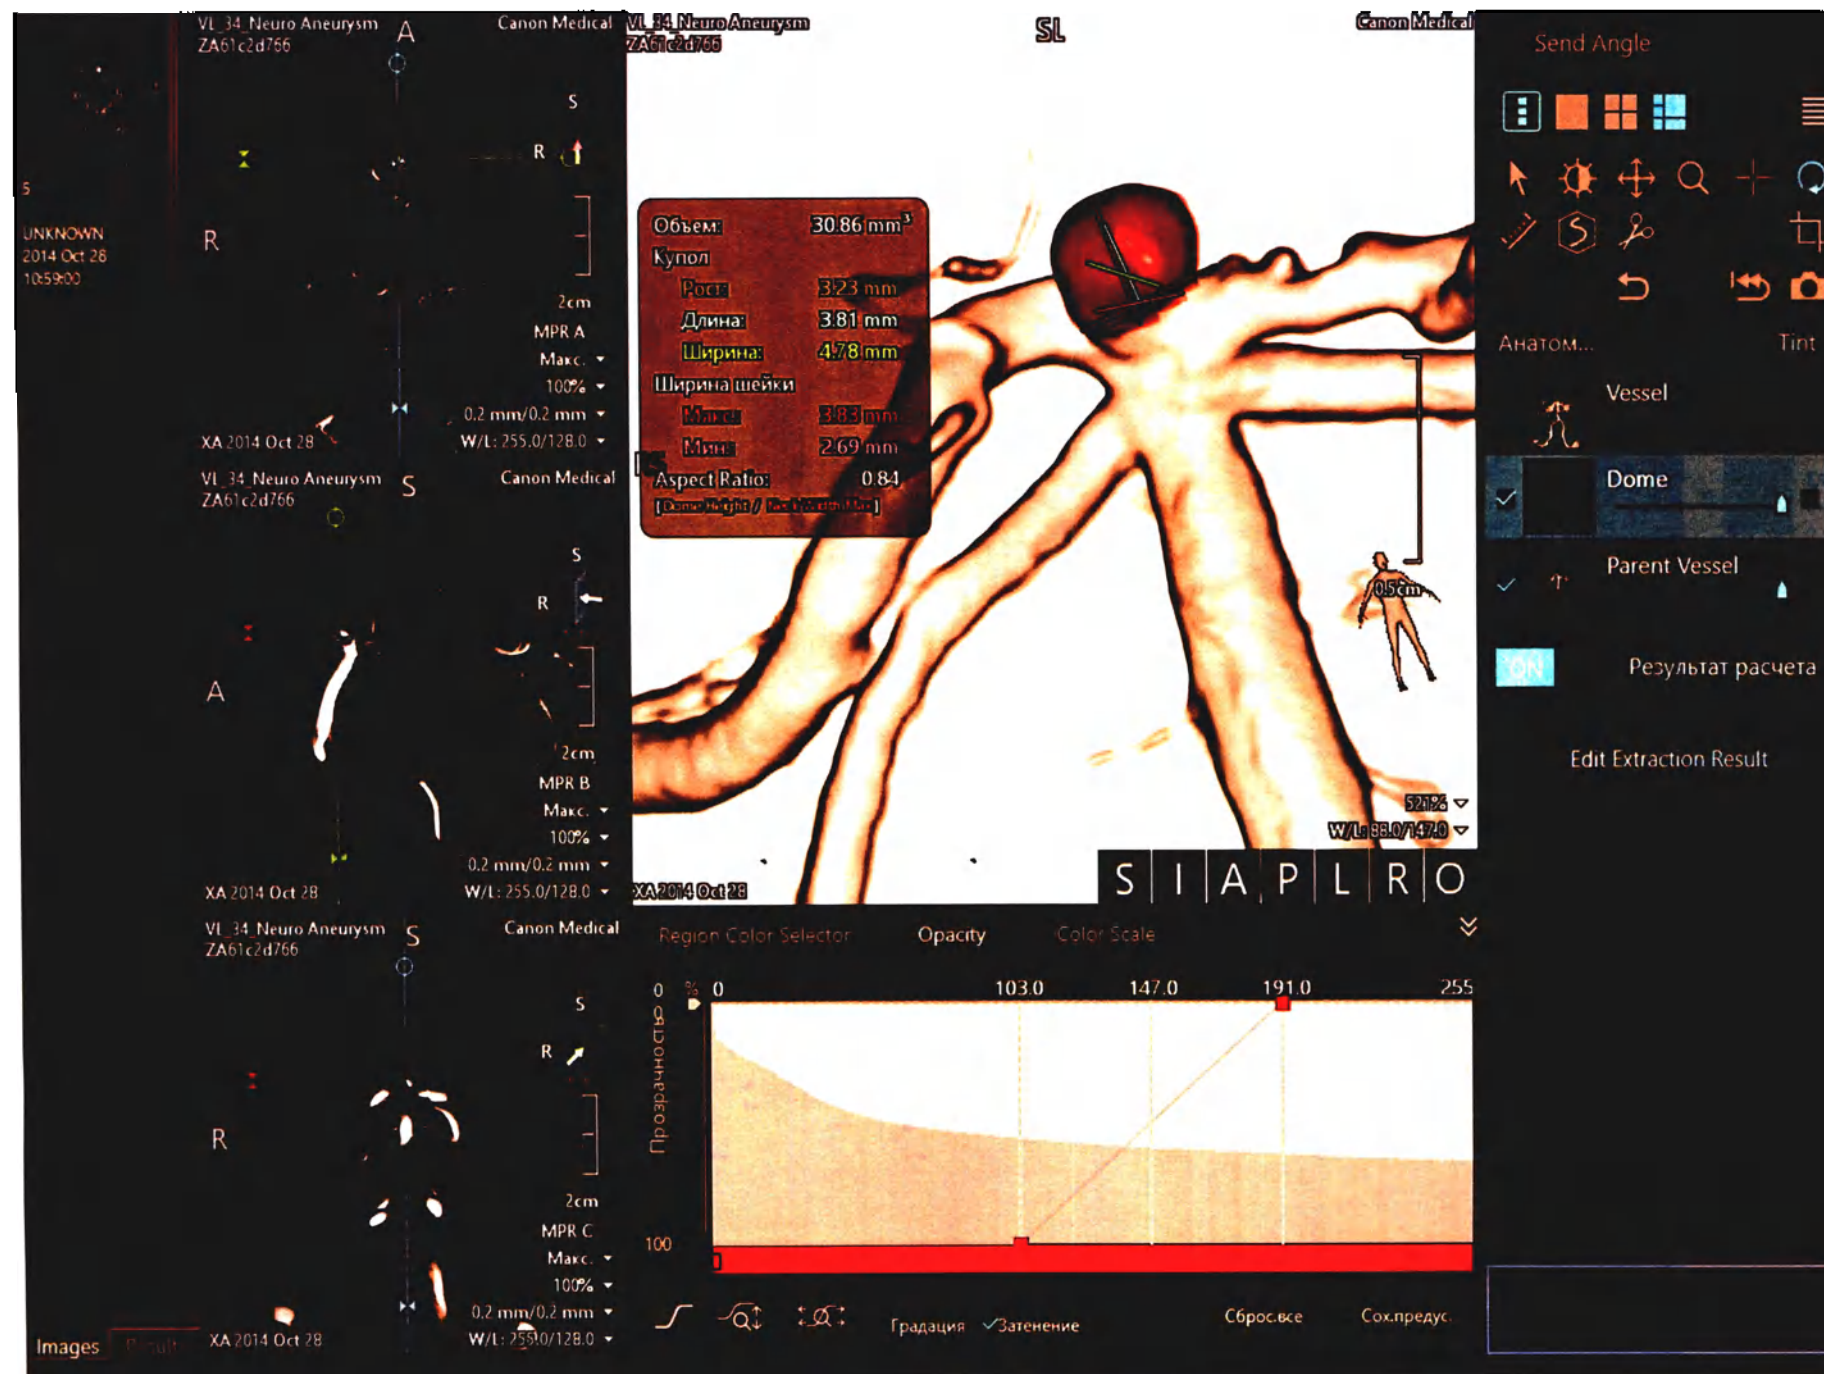


15. Приложение для планирования эмболизации (при необходимости)

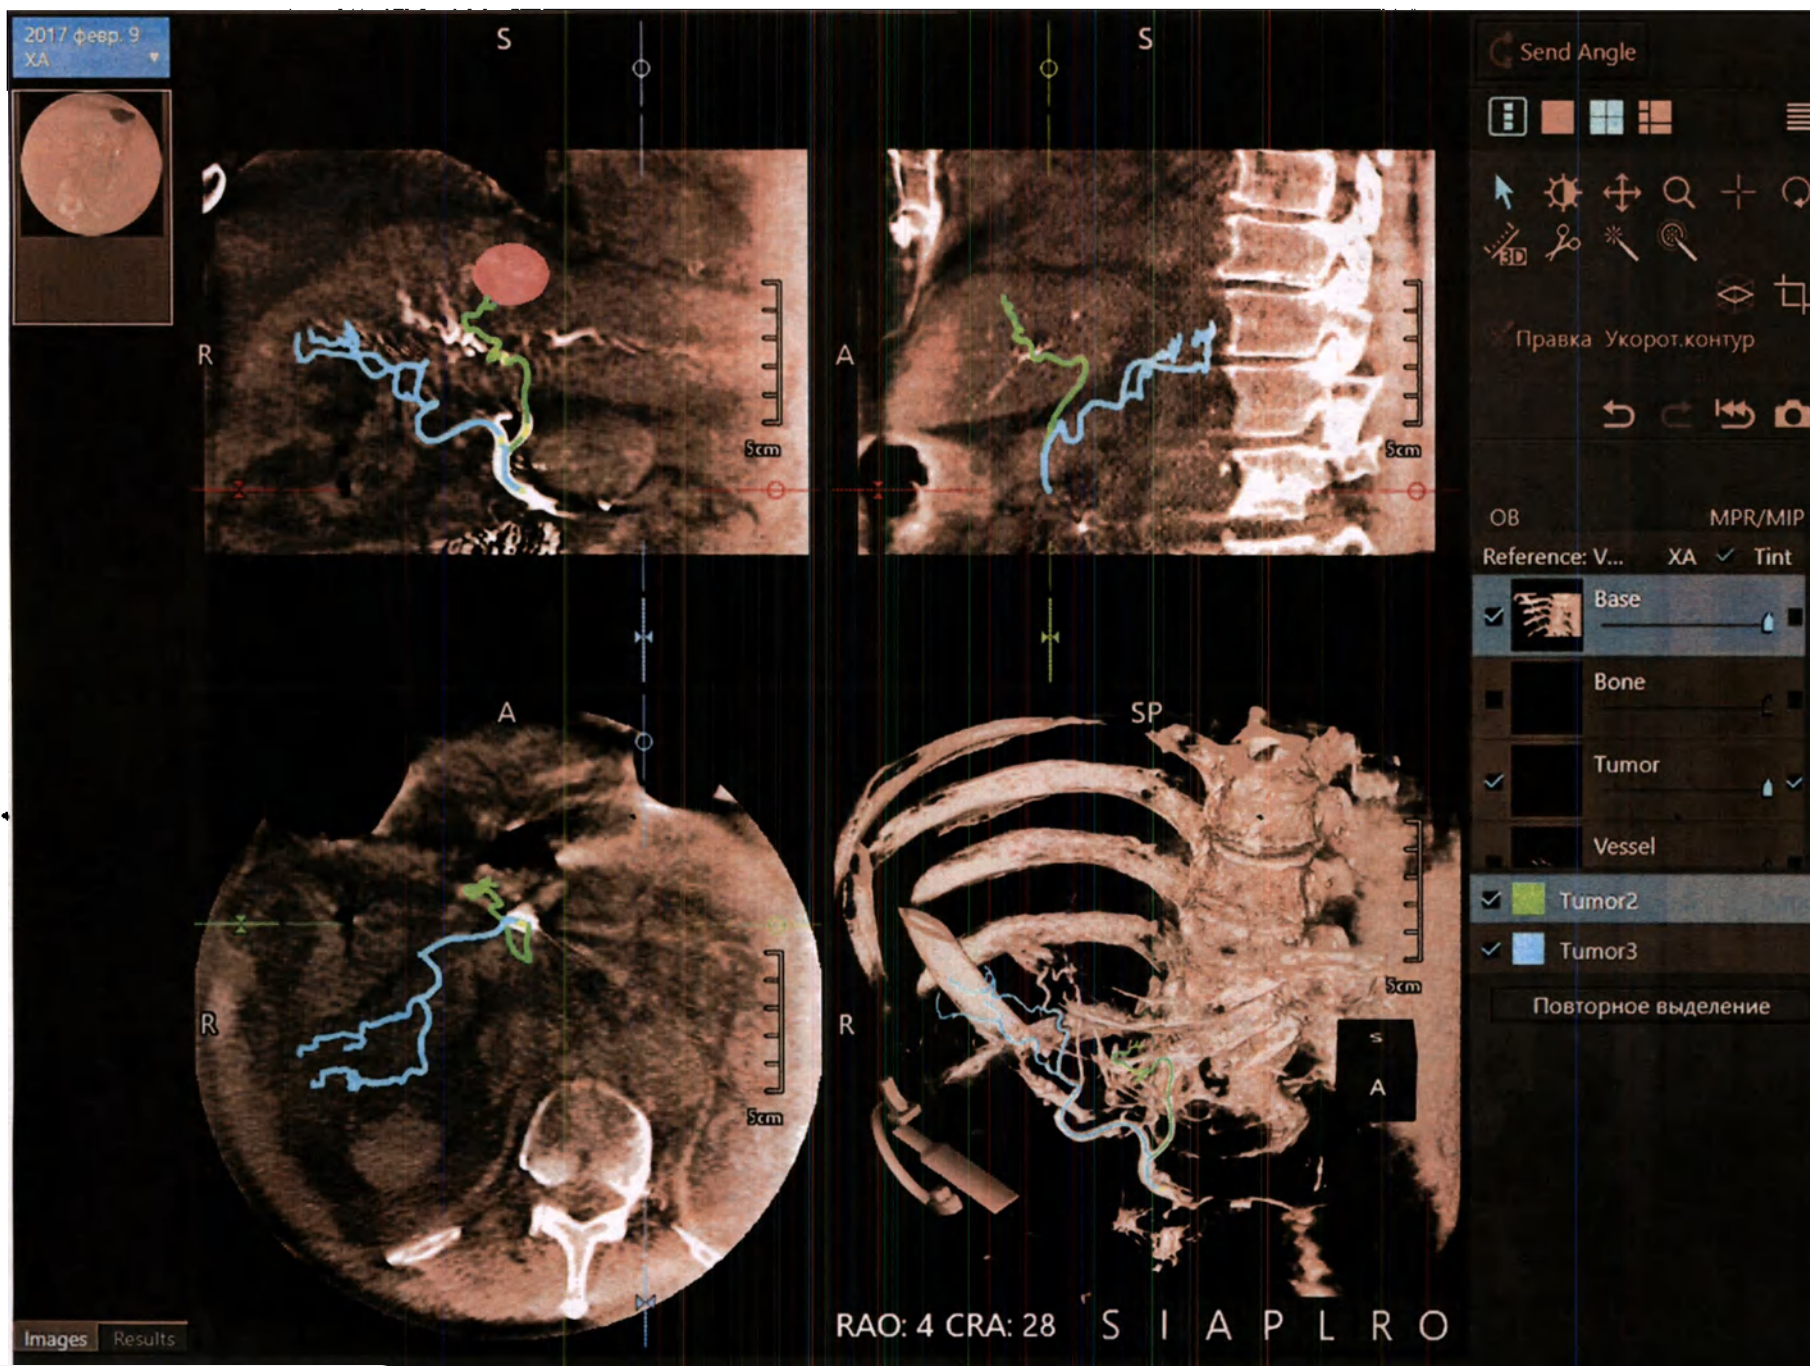


16. Программный пакет Vitrea CT Package №1 (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

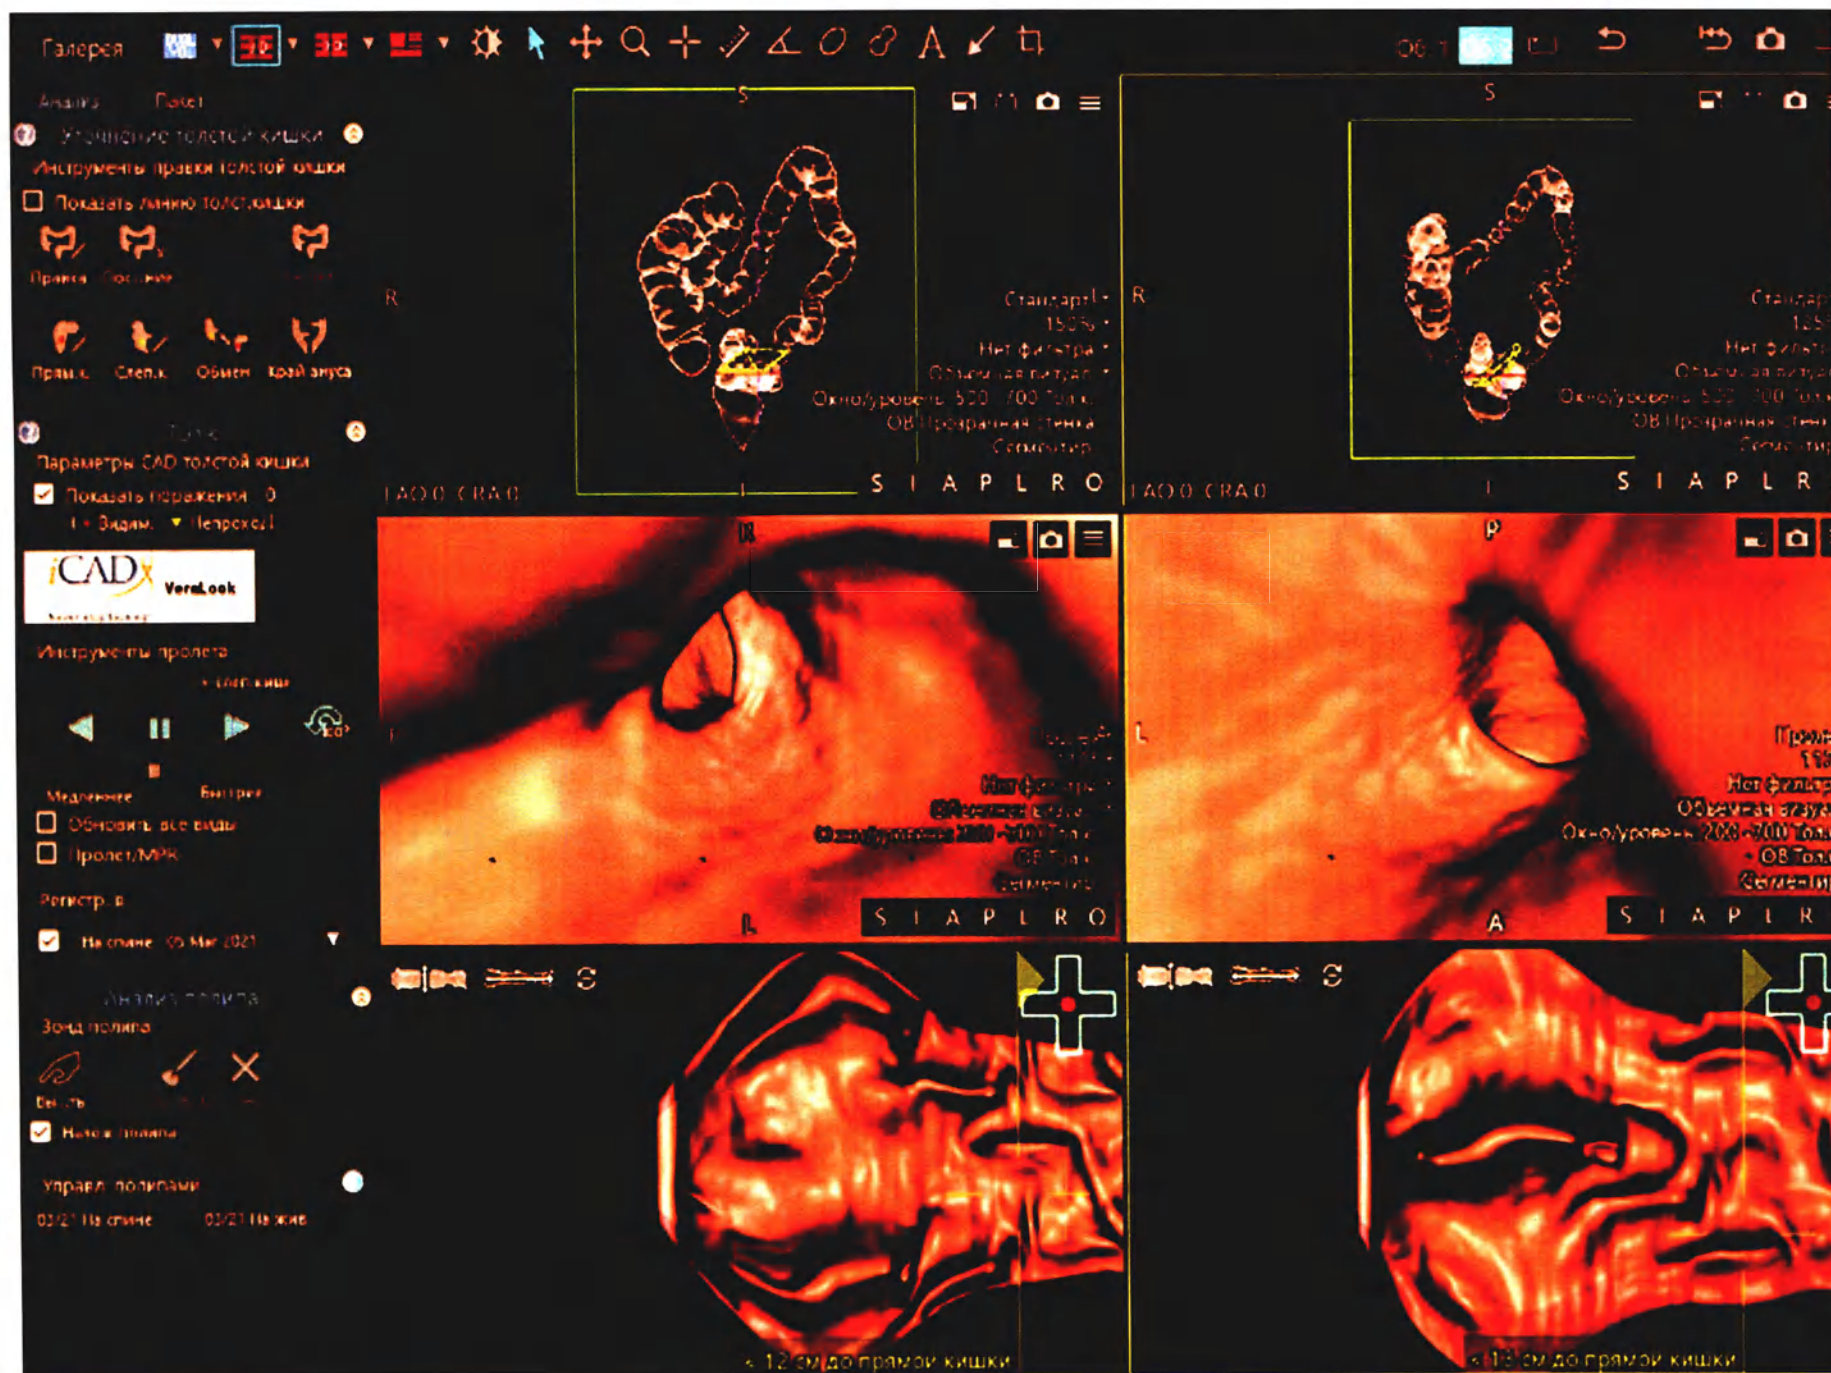


16. Программный пакет Vitrea CT Package №1 (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

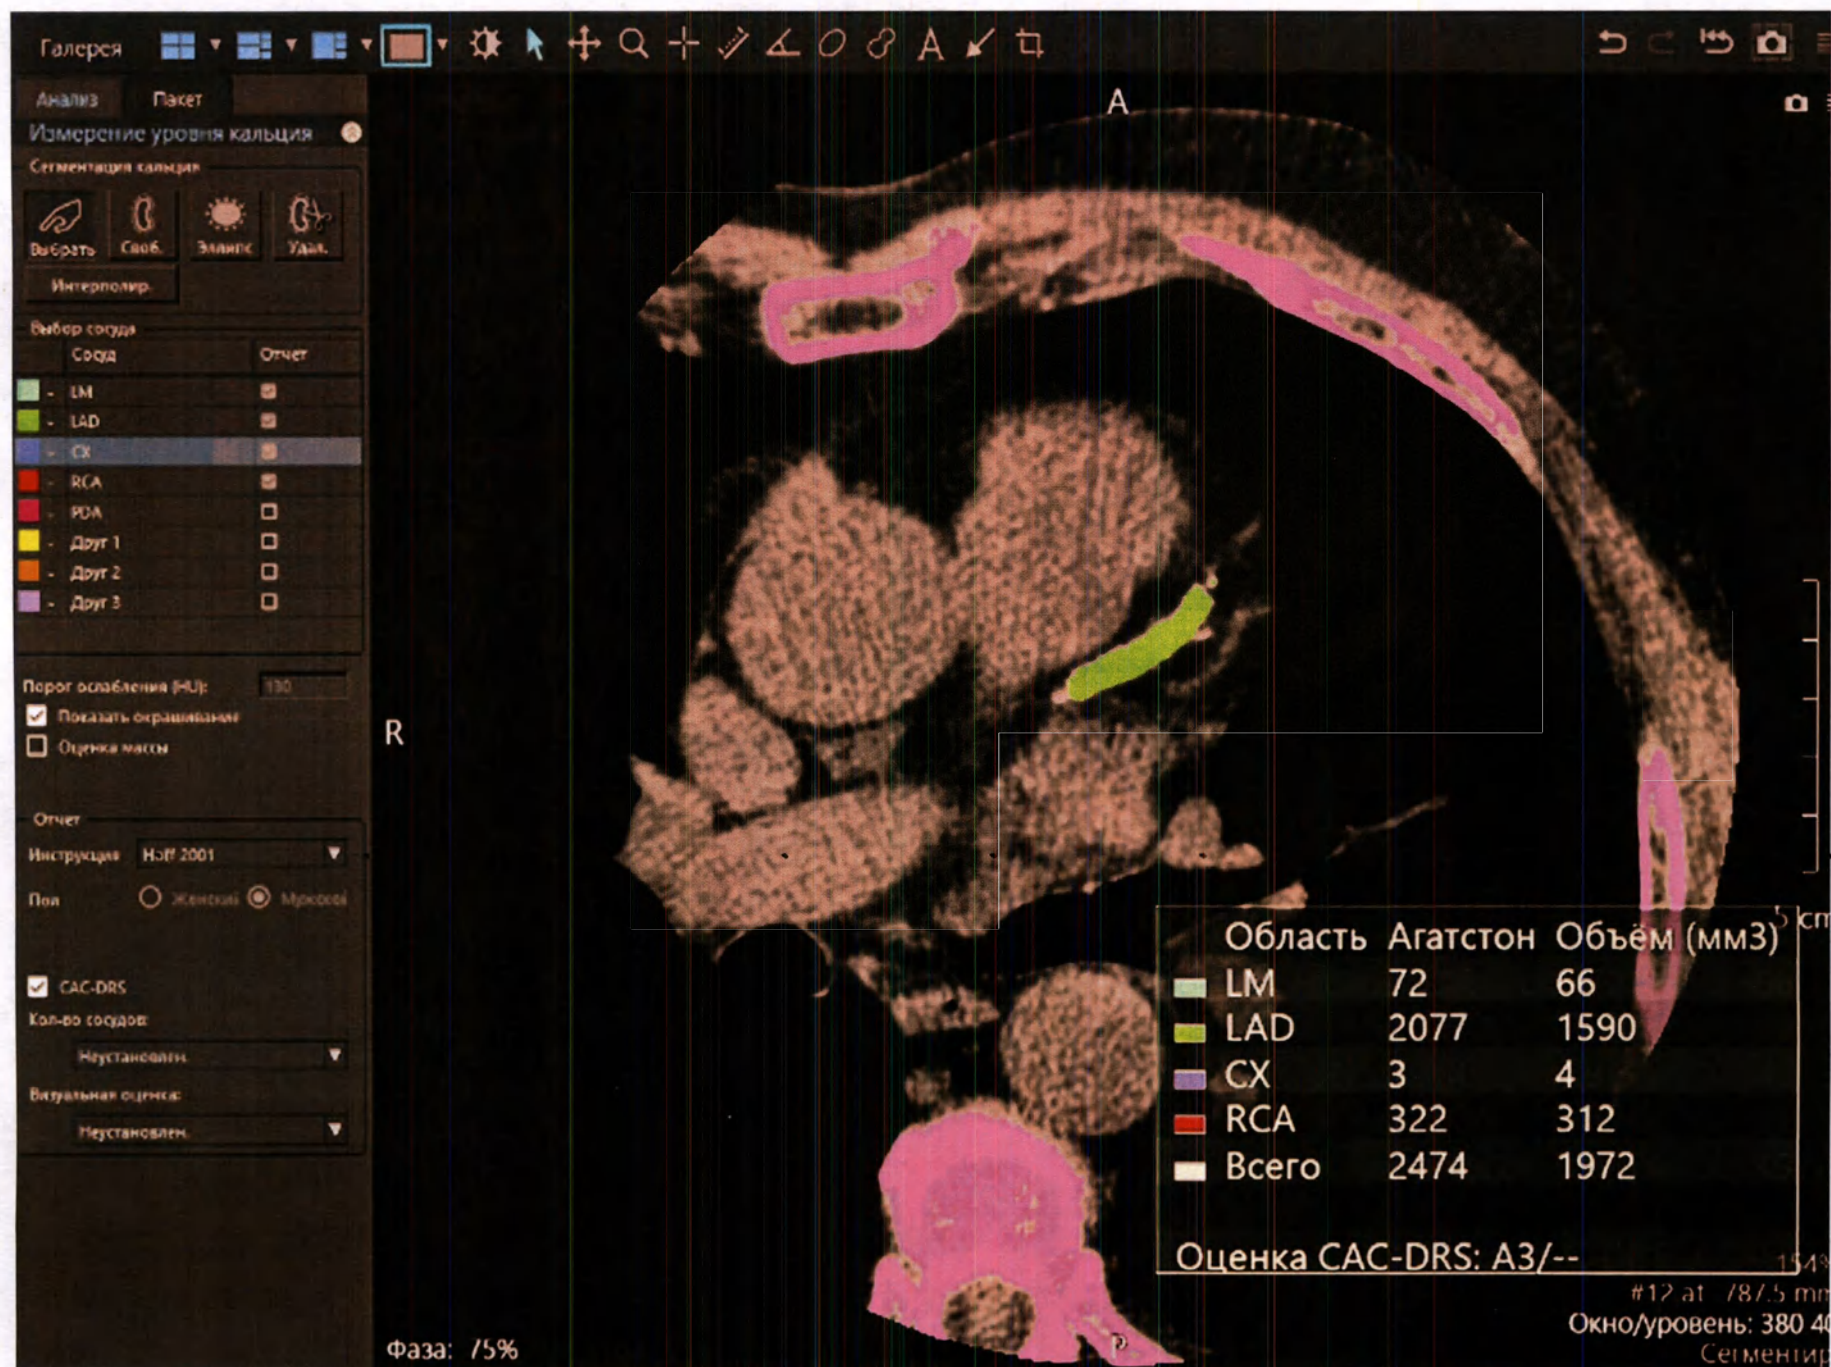


16. Программный пакет Vitrea CT Package №1 (при необходимости) (Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов)

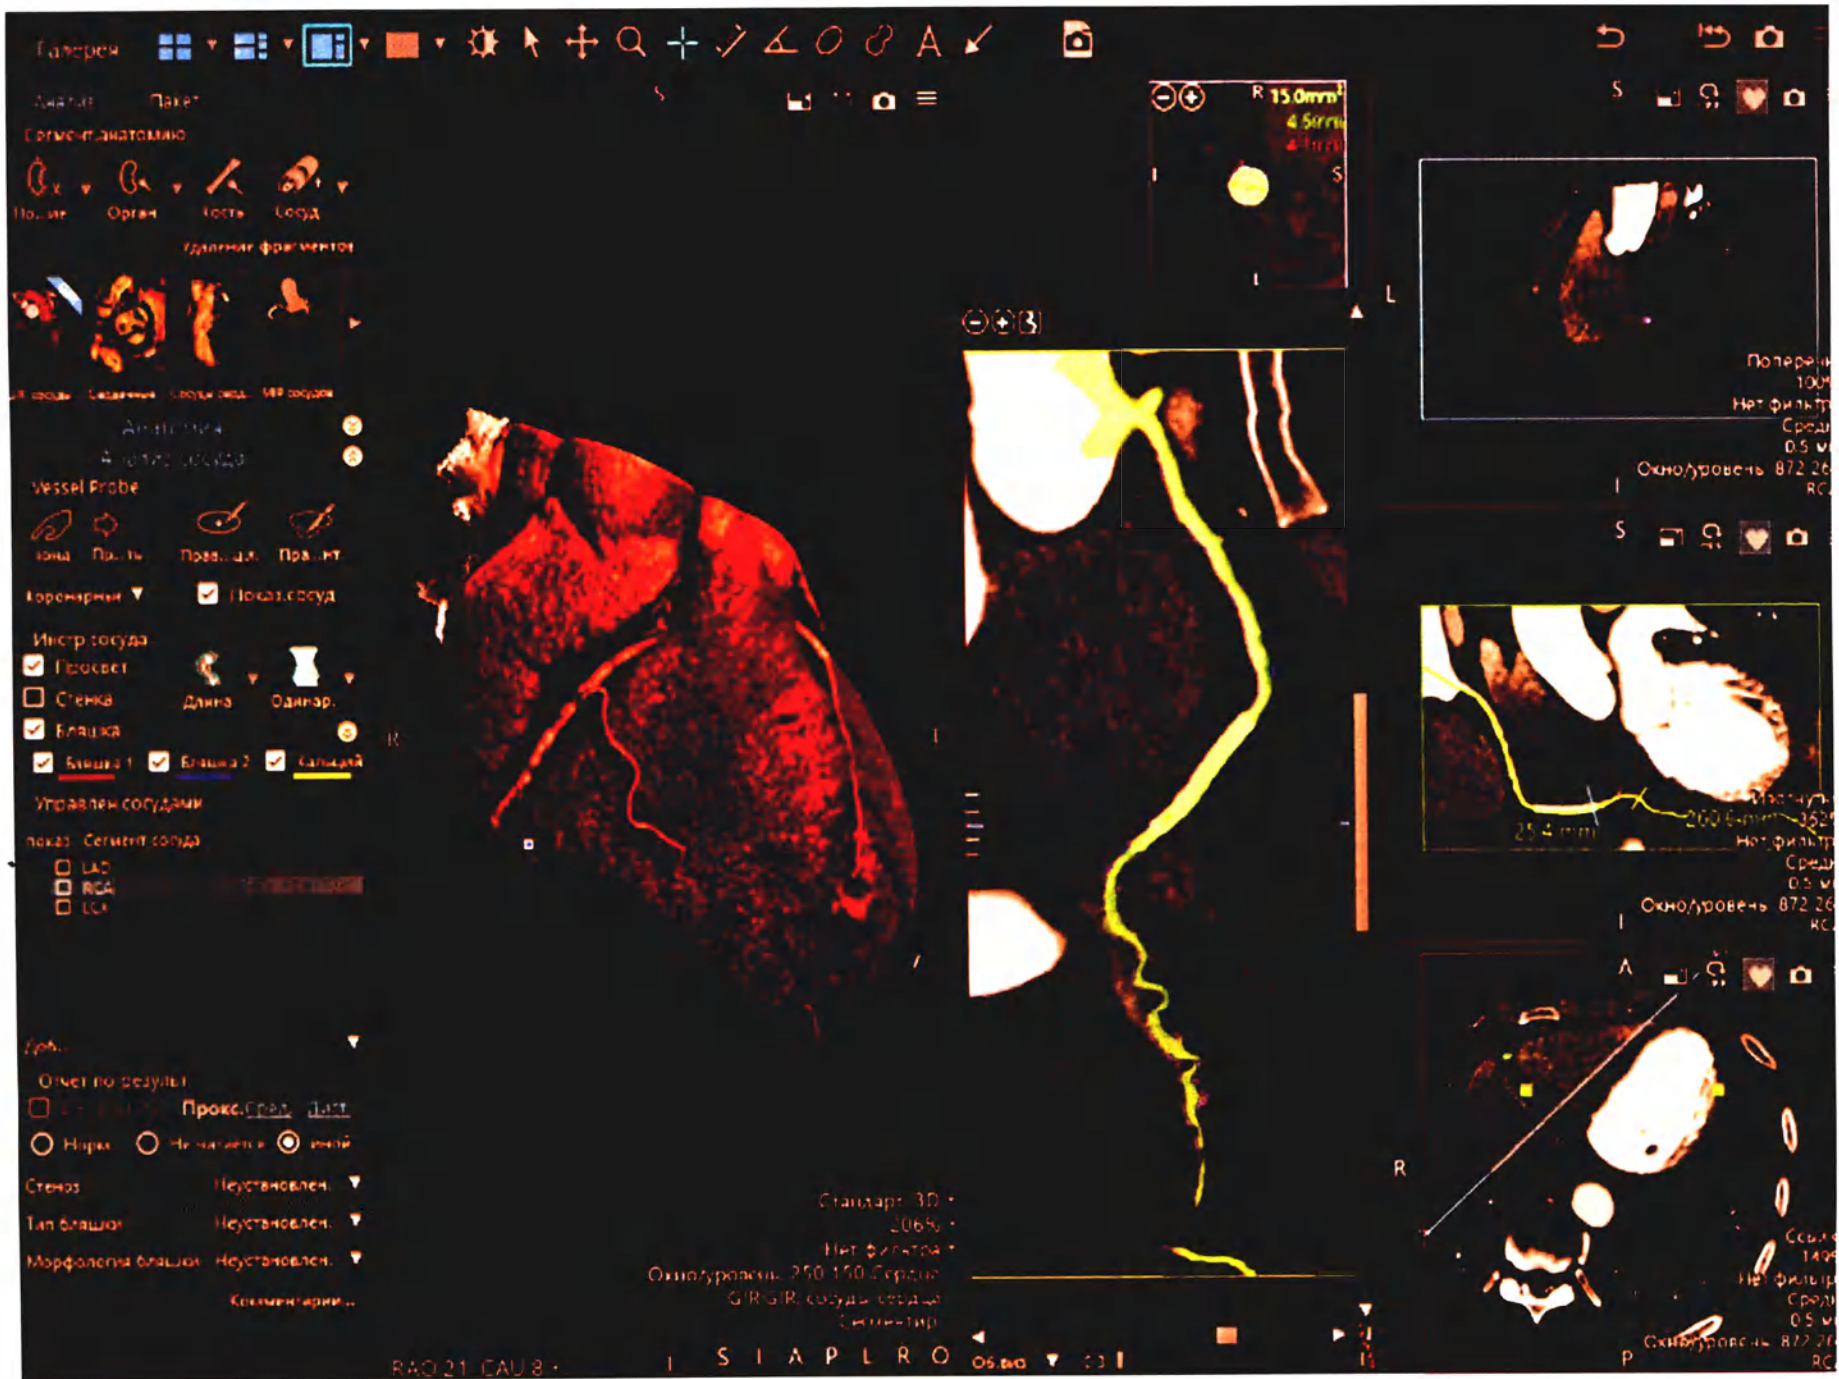

16. Программный пакет Vitrea CT Package №1 (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

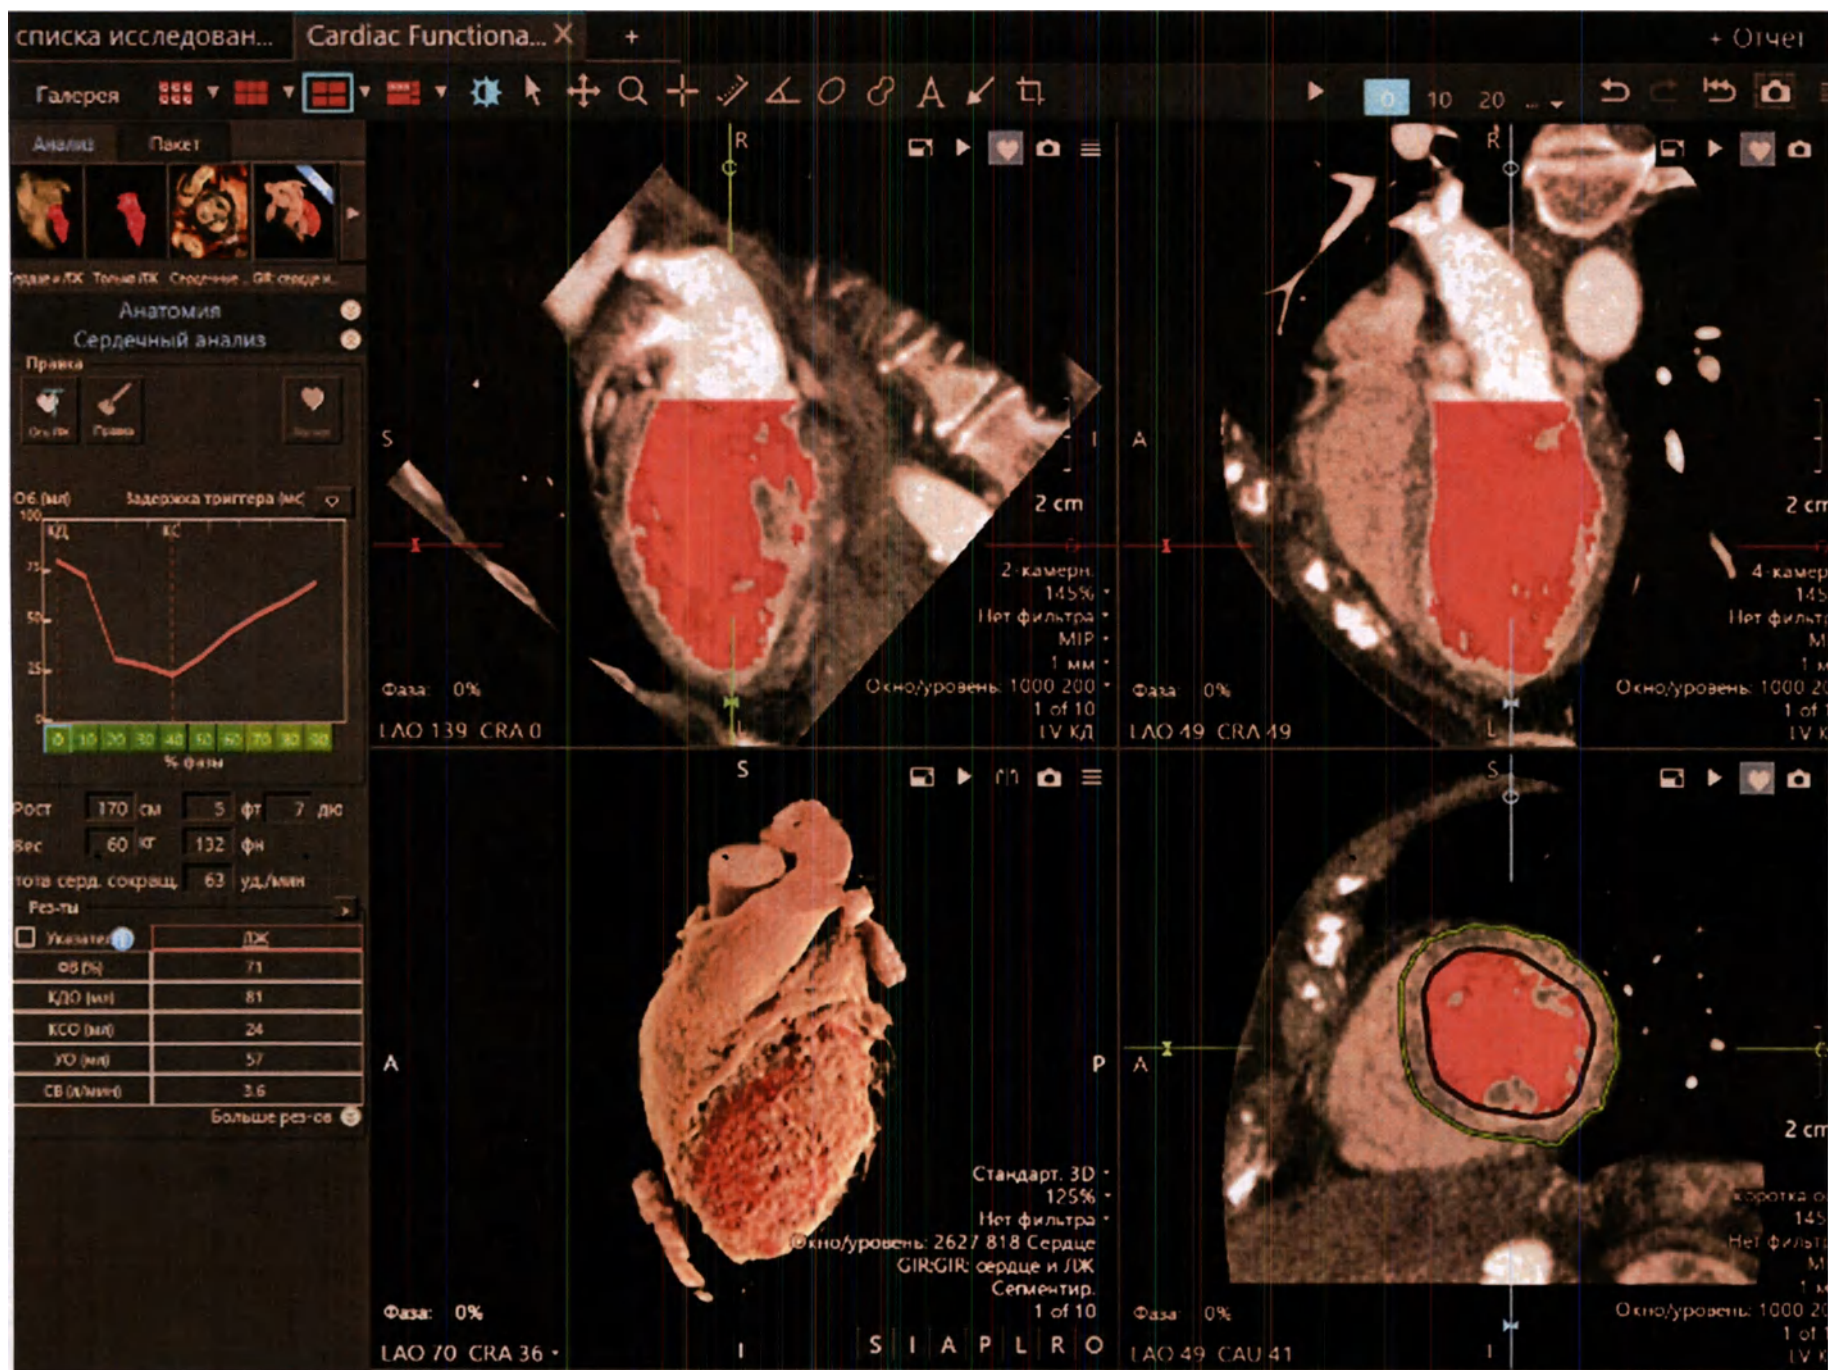


17. Программный пакет Vitrea CT Package №2 (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

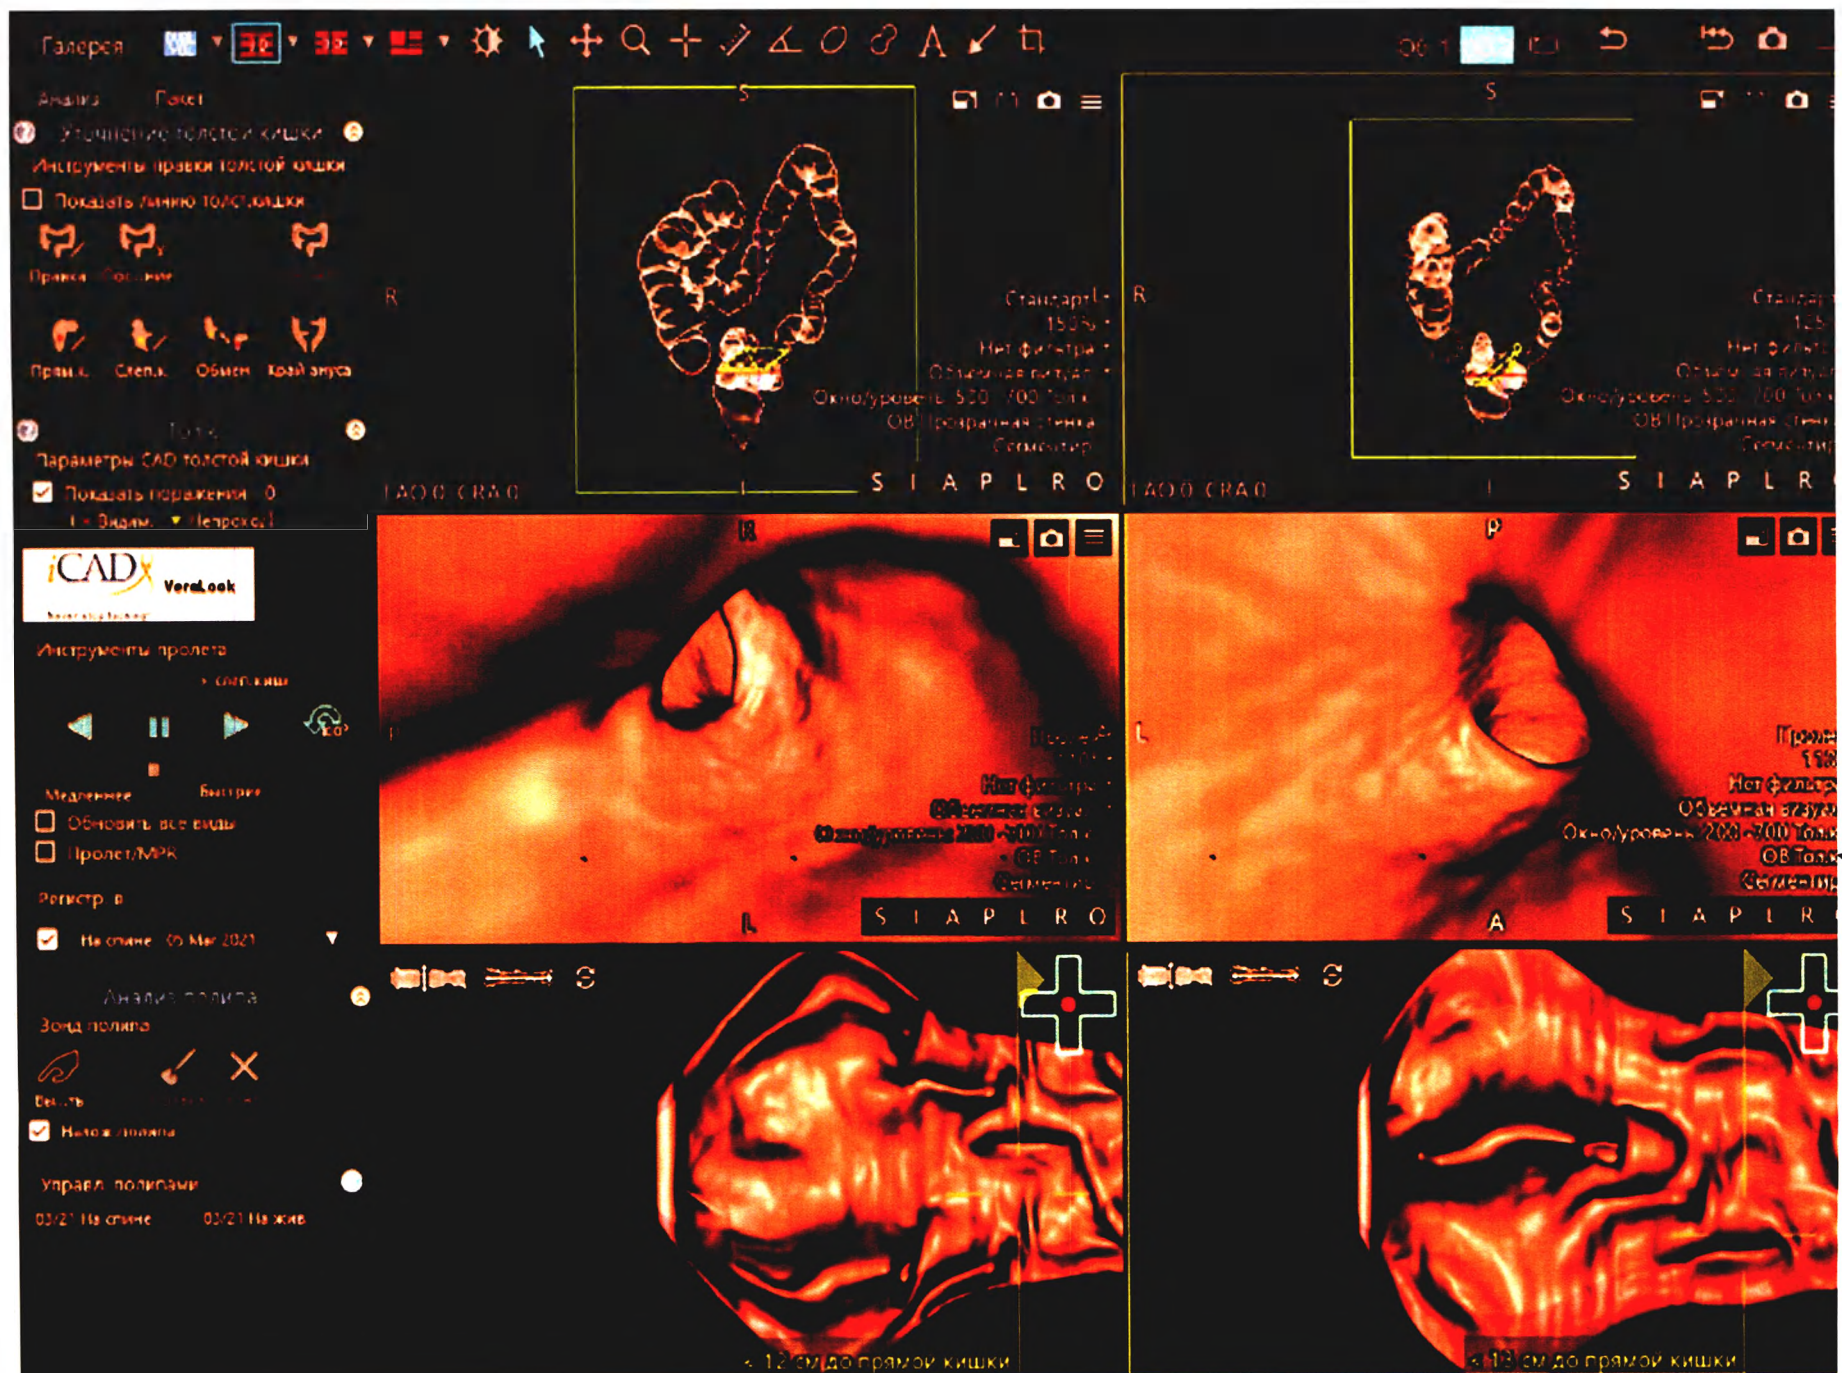


17. Программный пакет Vitrea CT Package №2 (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)




17. Программный пакет Vitrea CT Package №2 (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

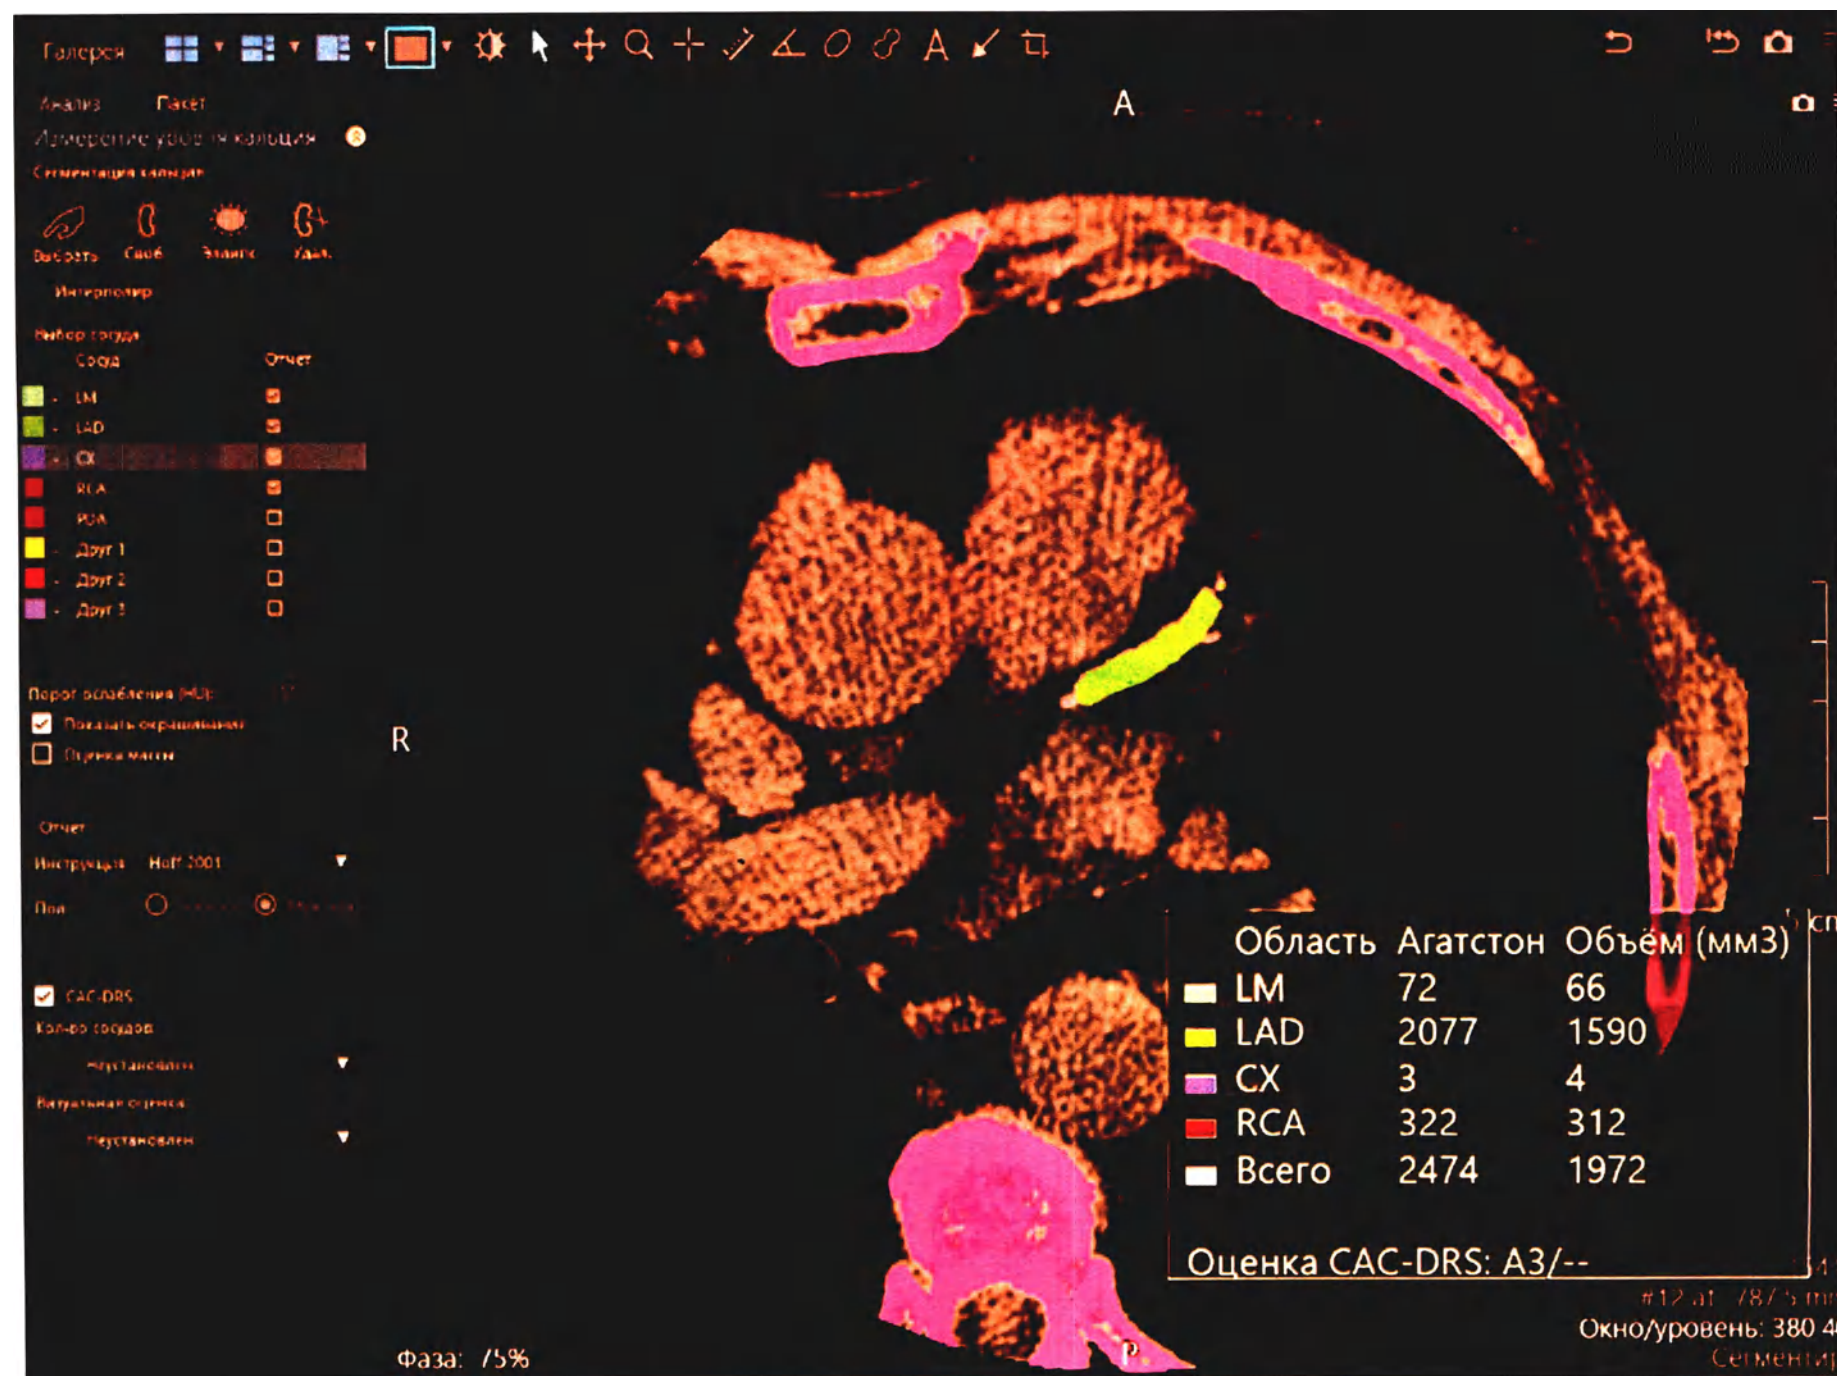


17. Программный пакет Vitrea CT Package №2 (при необходимости) (Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов)

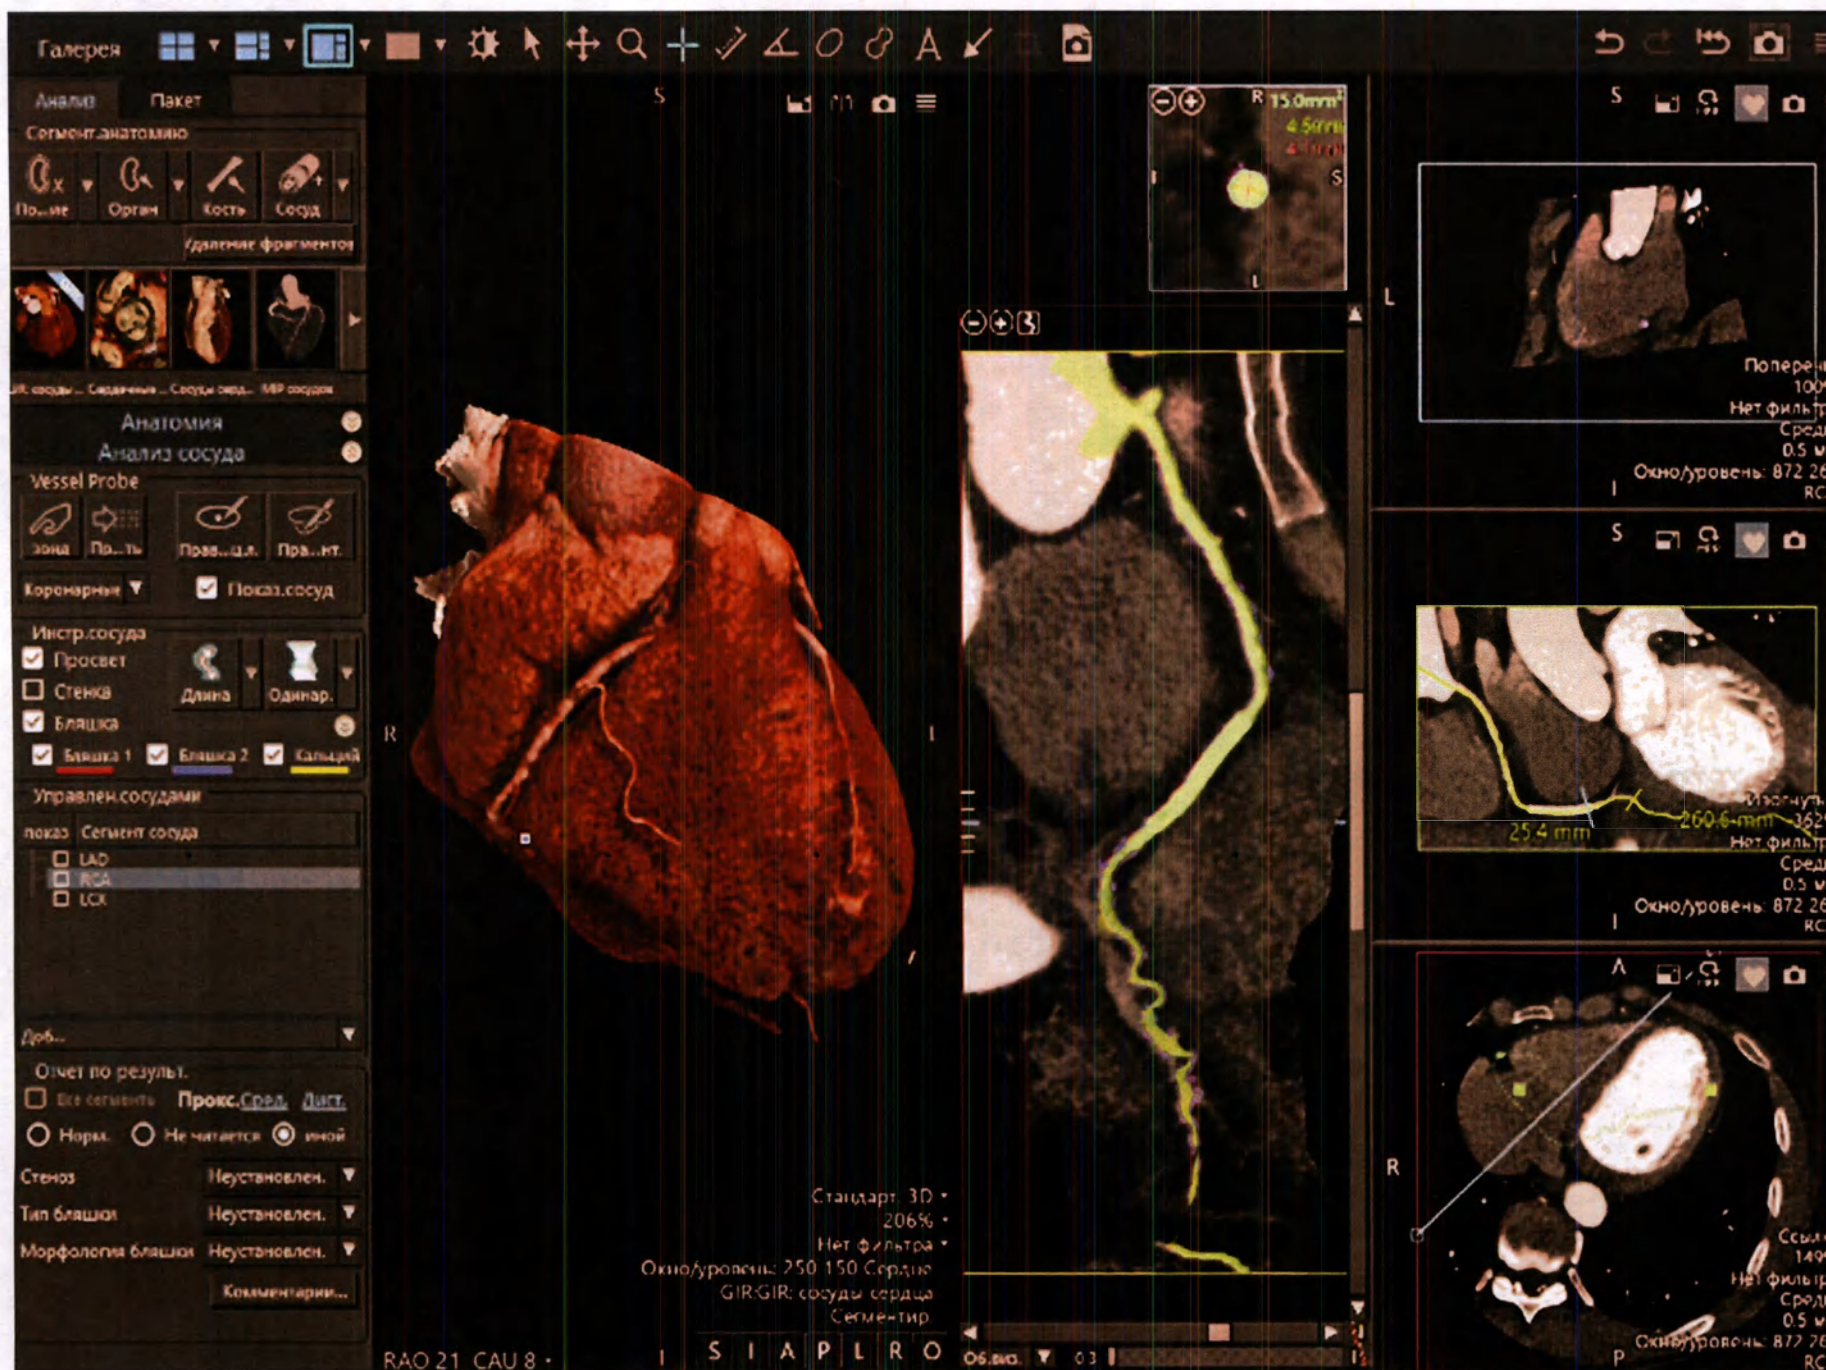


17. Программный пакет Vitrea CT Package №2 (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

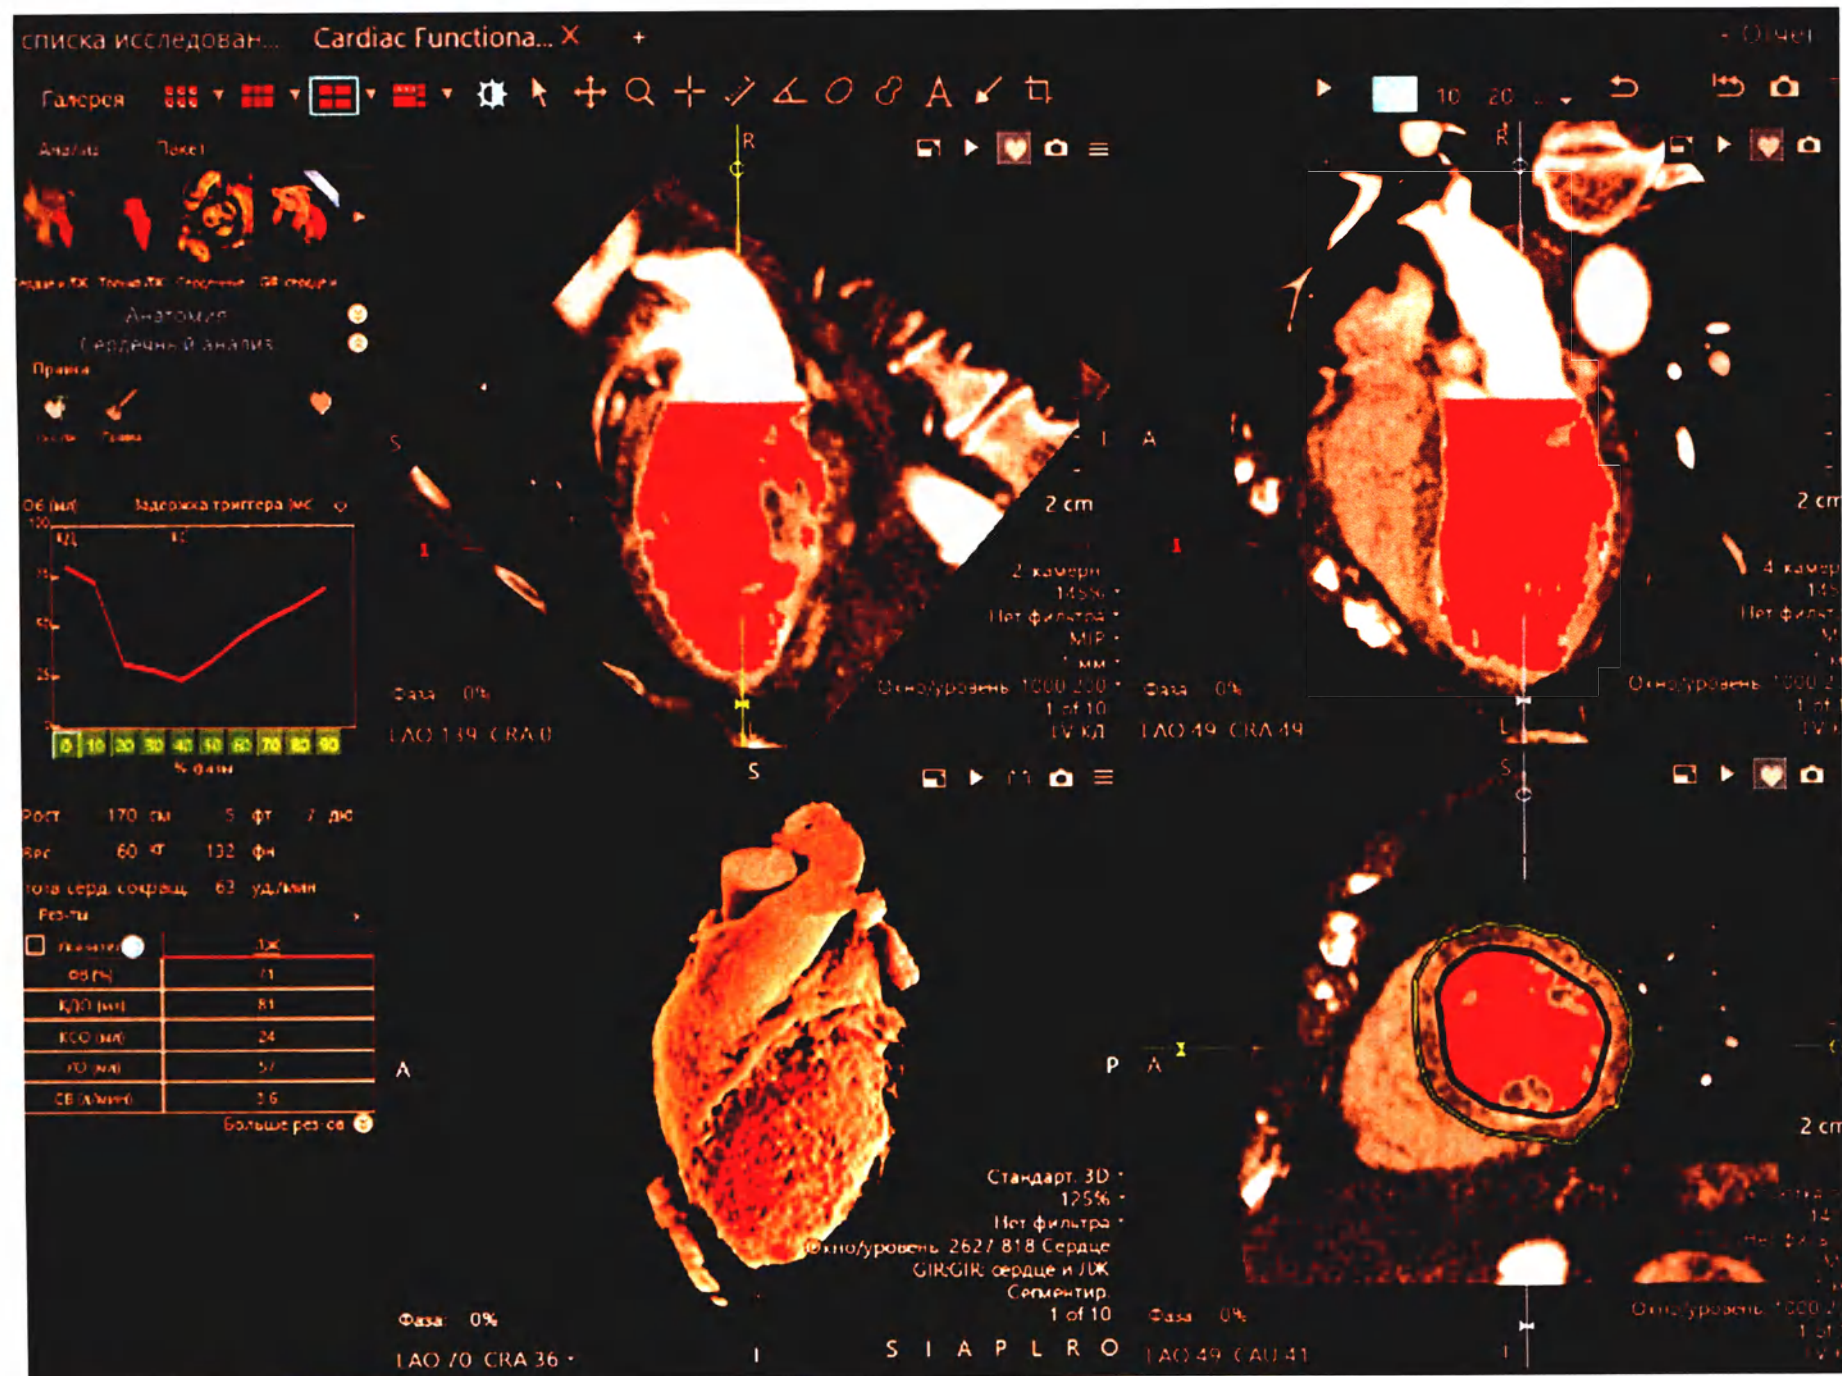


18. Программный пакет Vitrea CT Package №3 (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

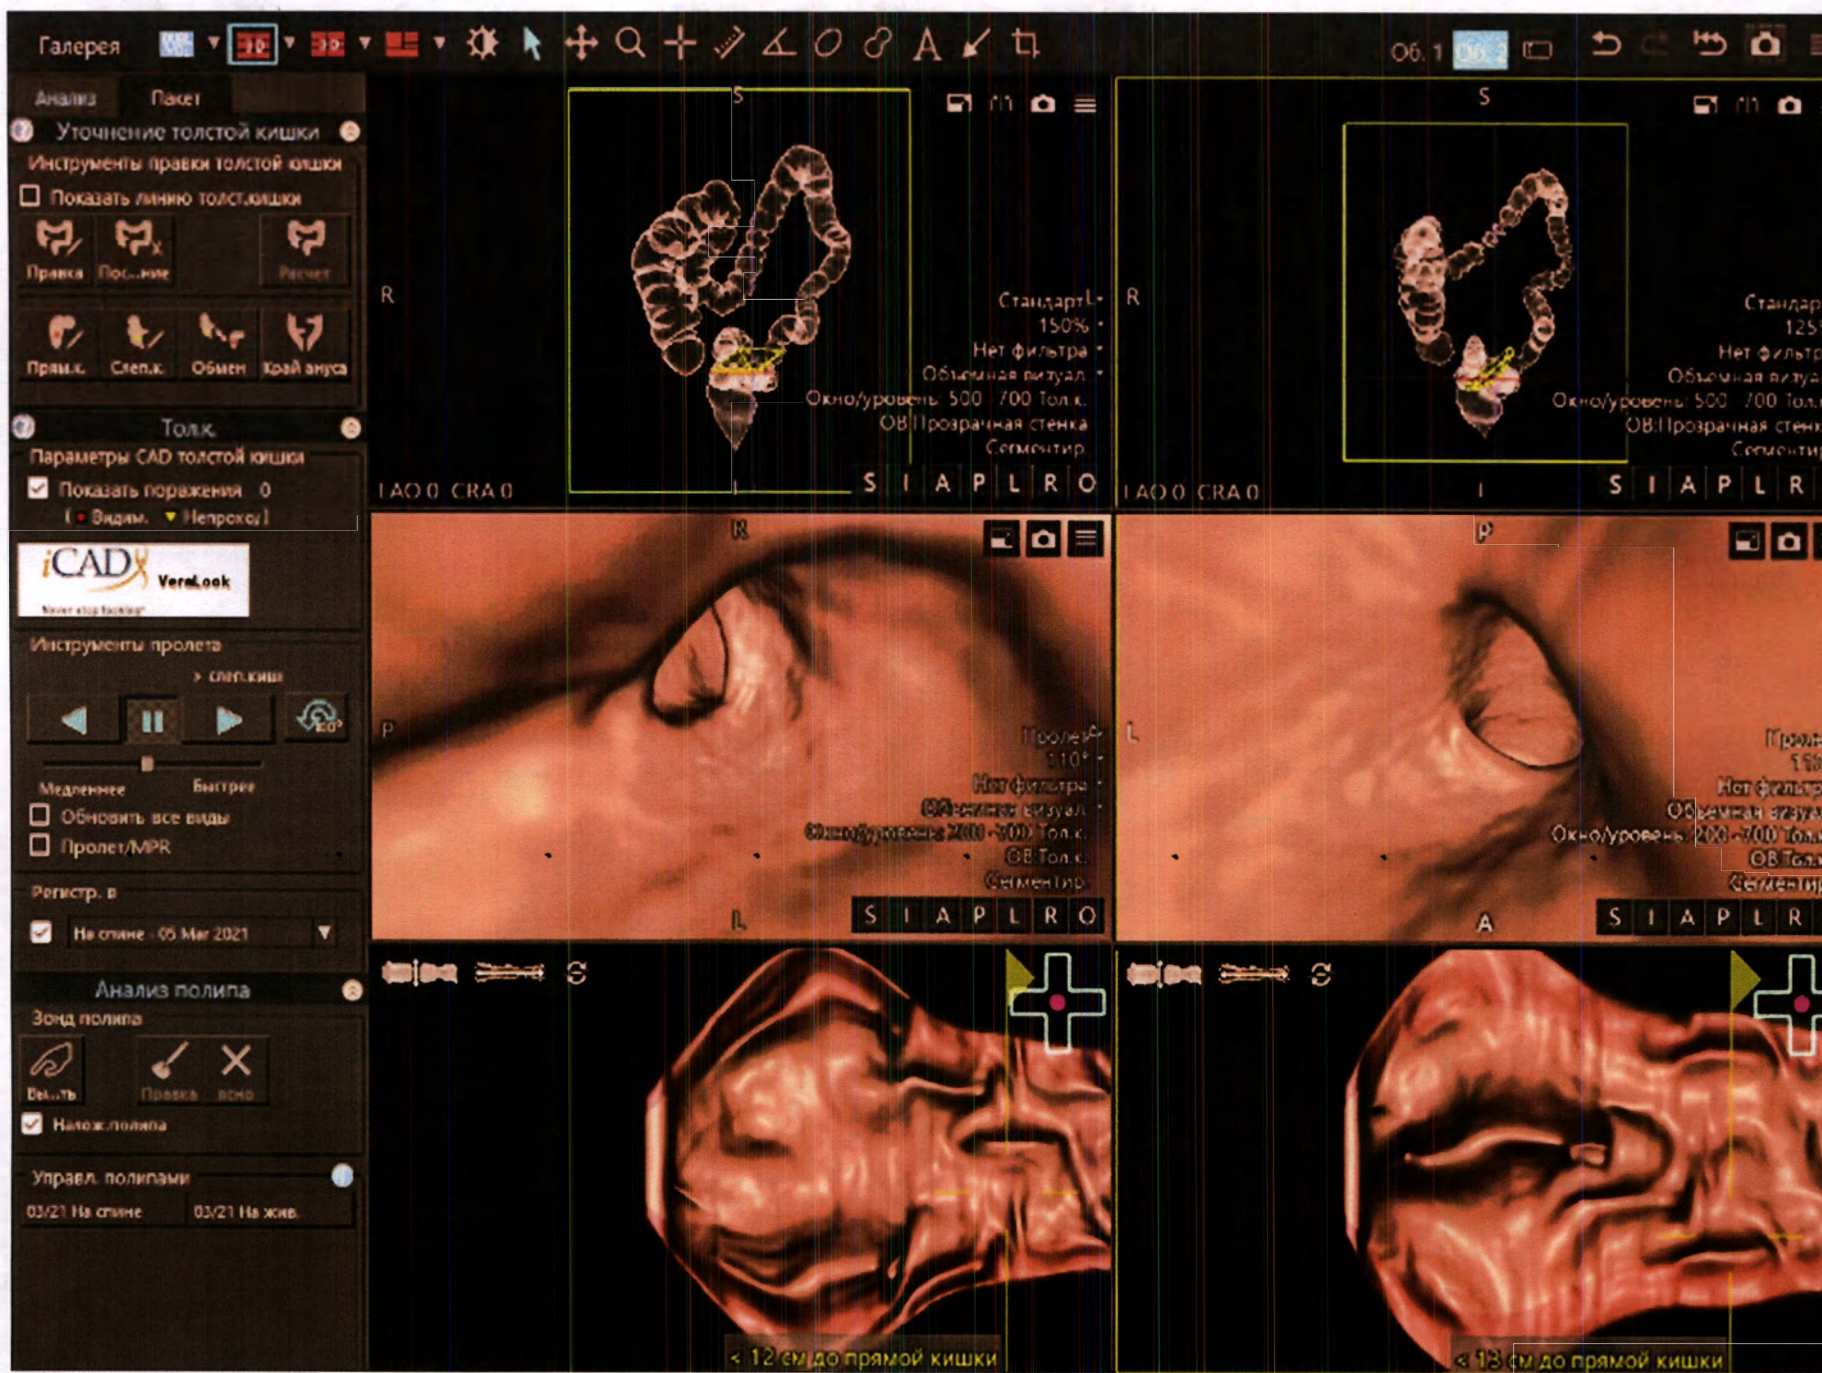


18. Программный пакет Vitrea CT Package №3 (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)

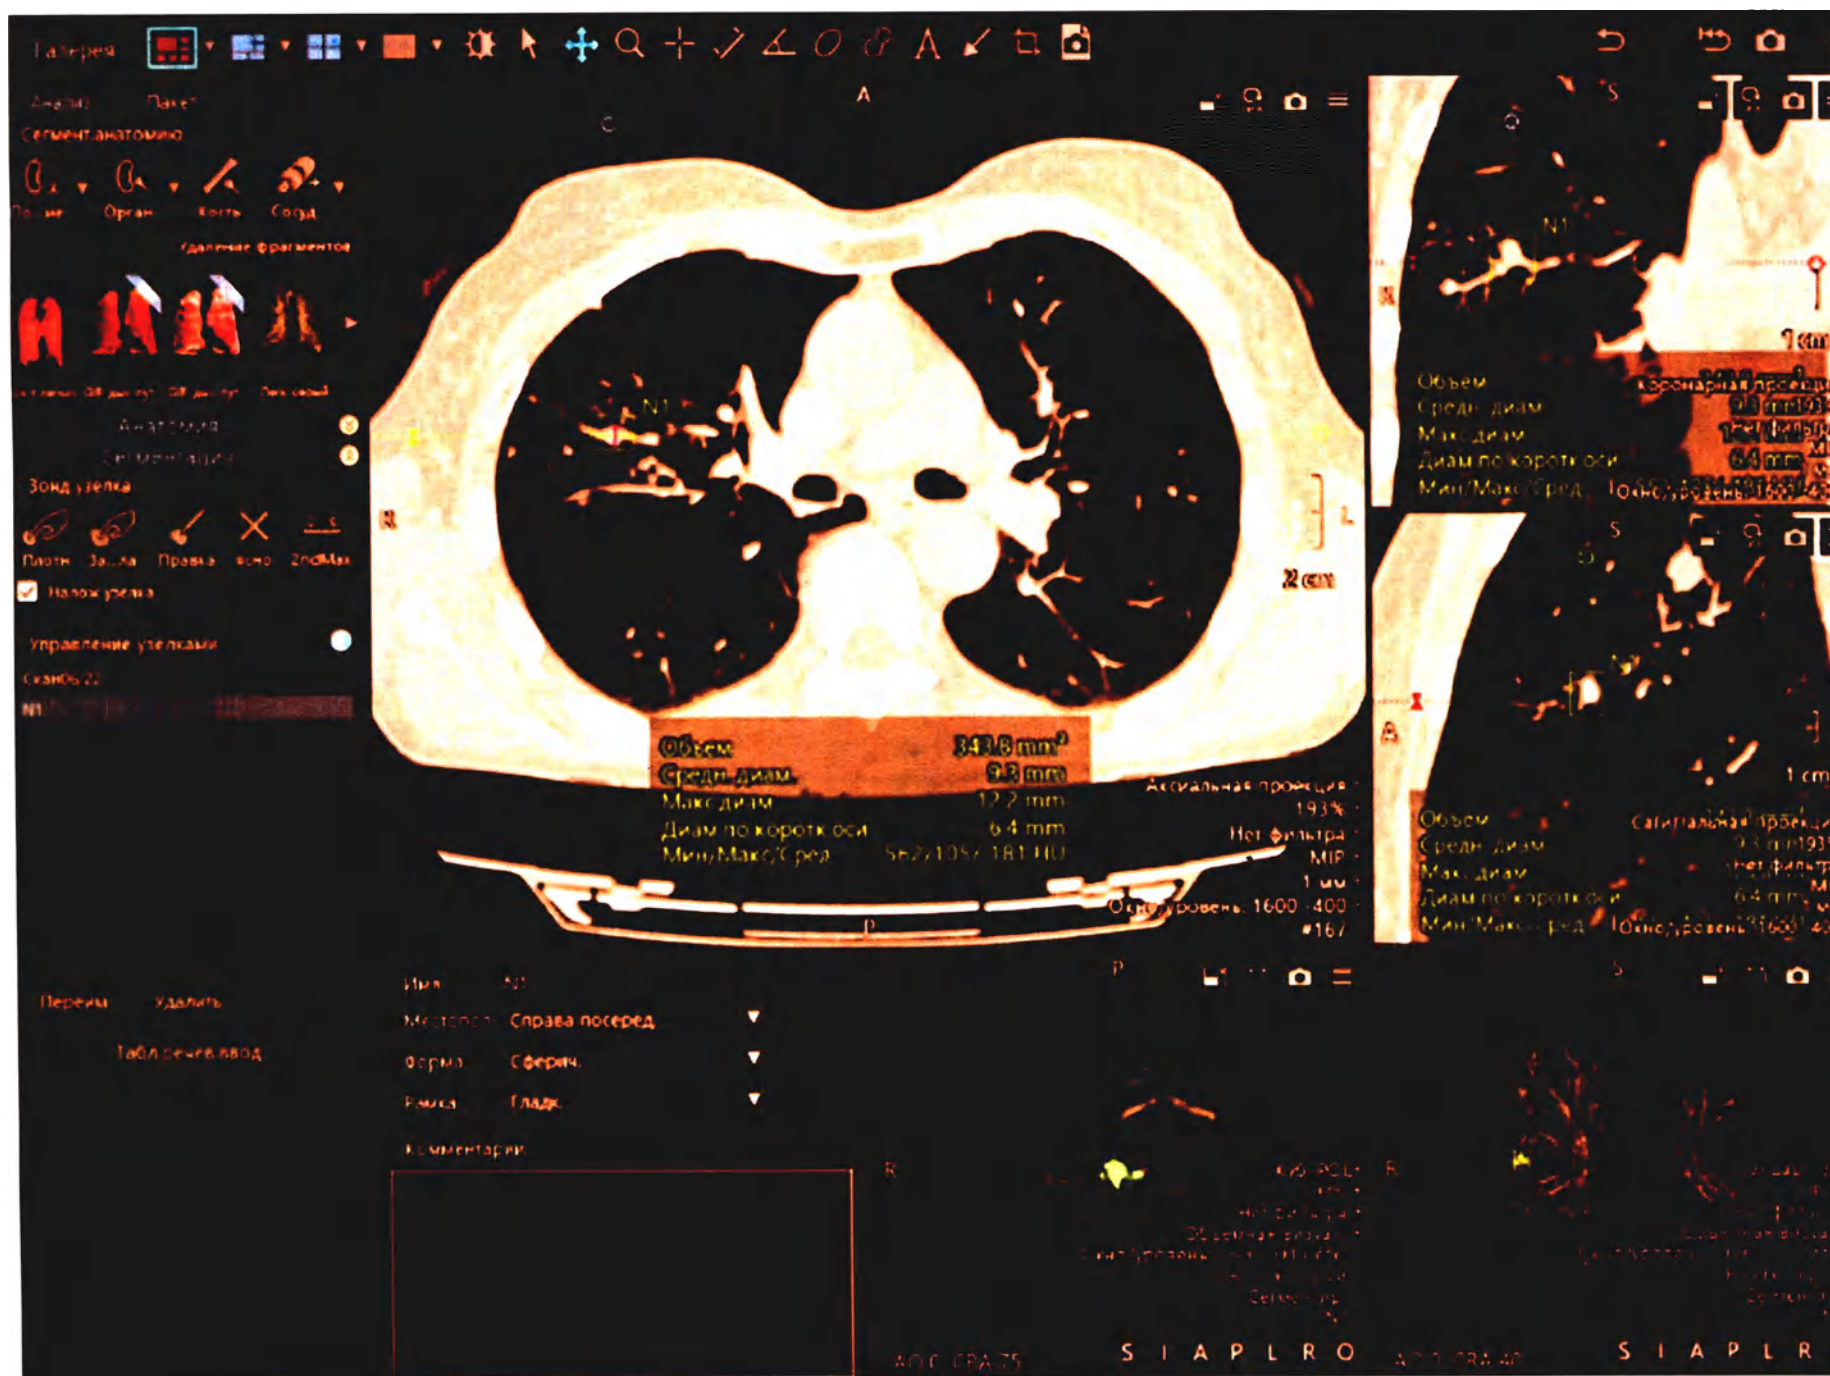


18. Программный пакет Vitrea CT Package №3 (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

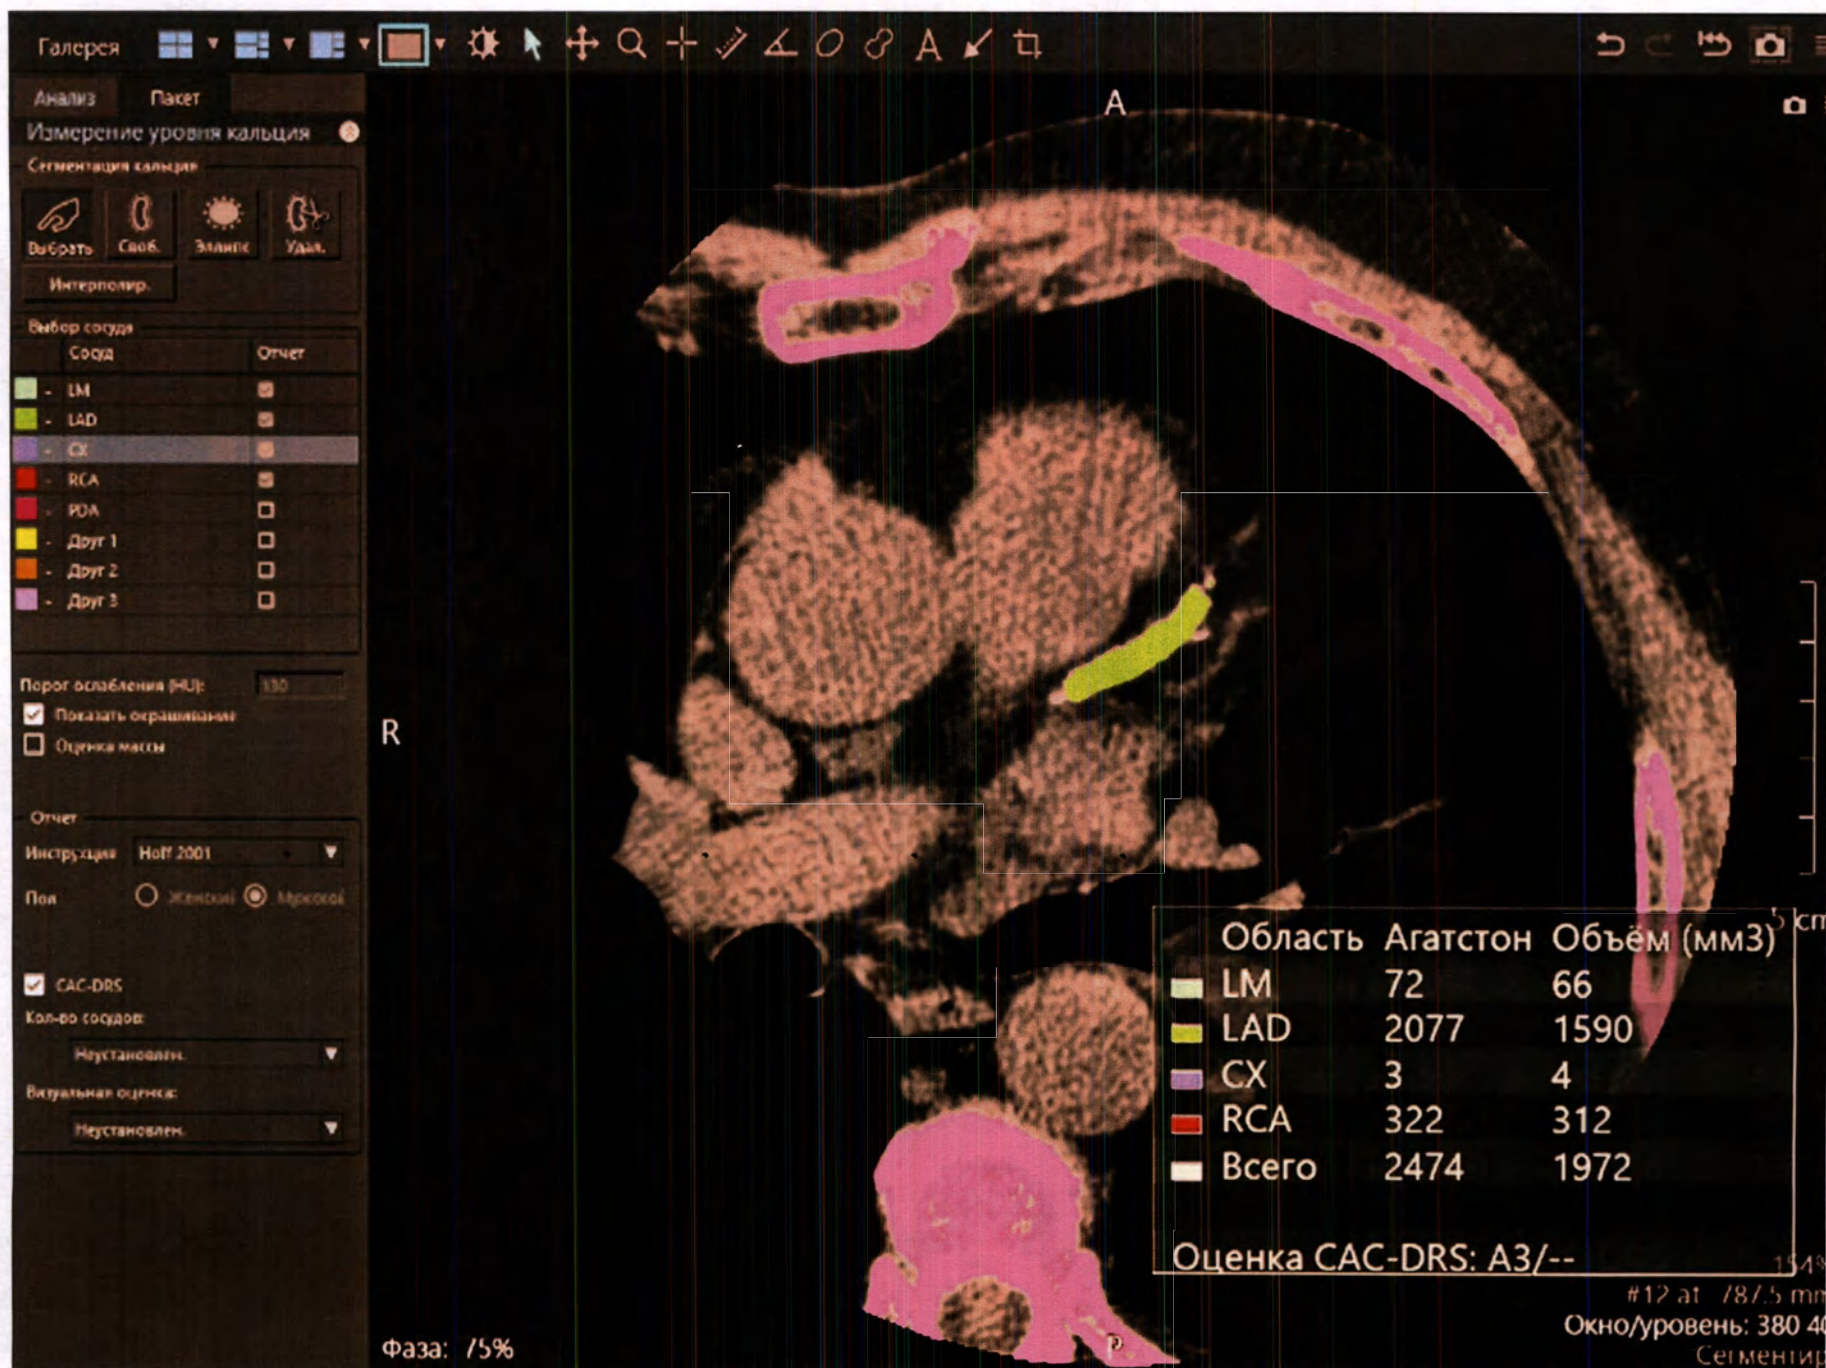


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для планирования установки стента)

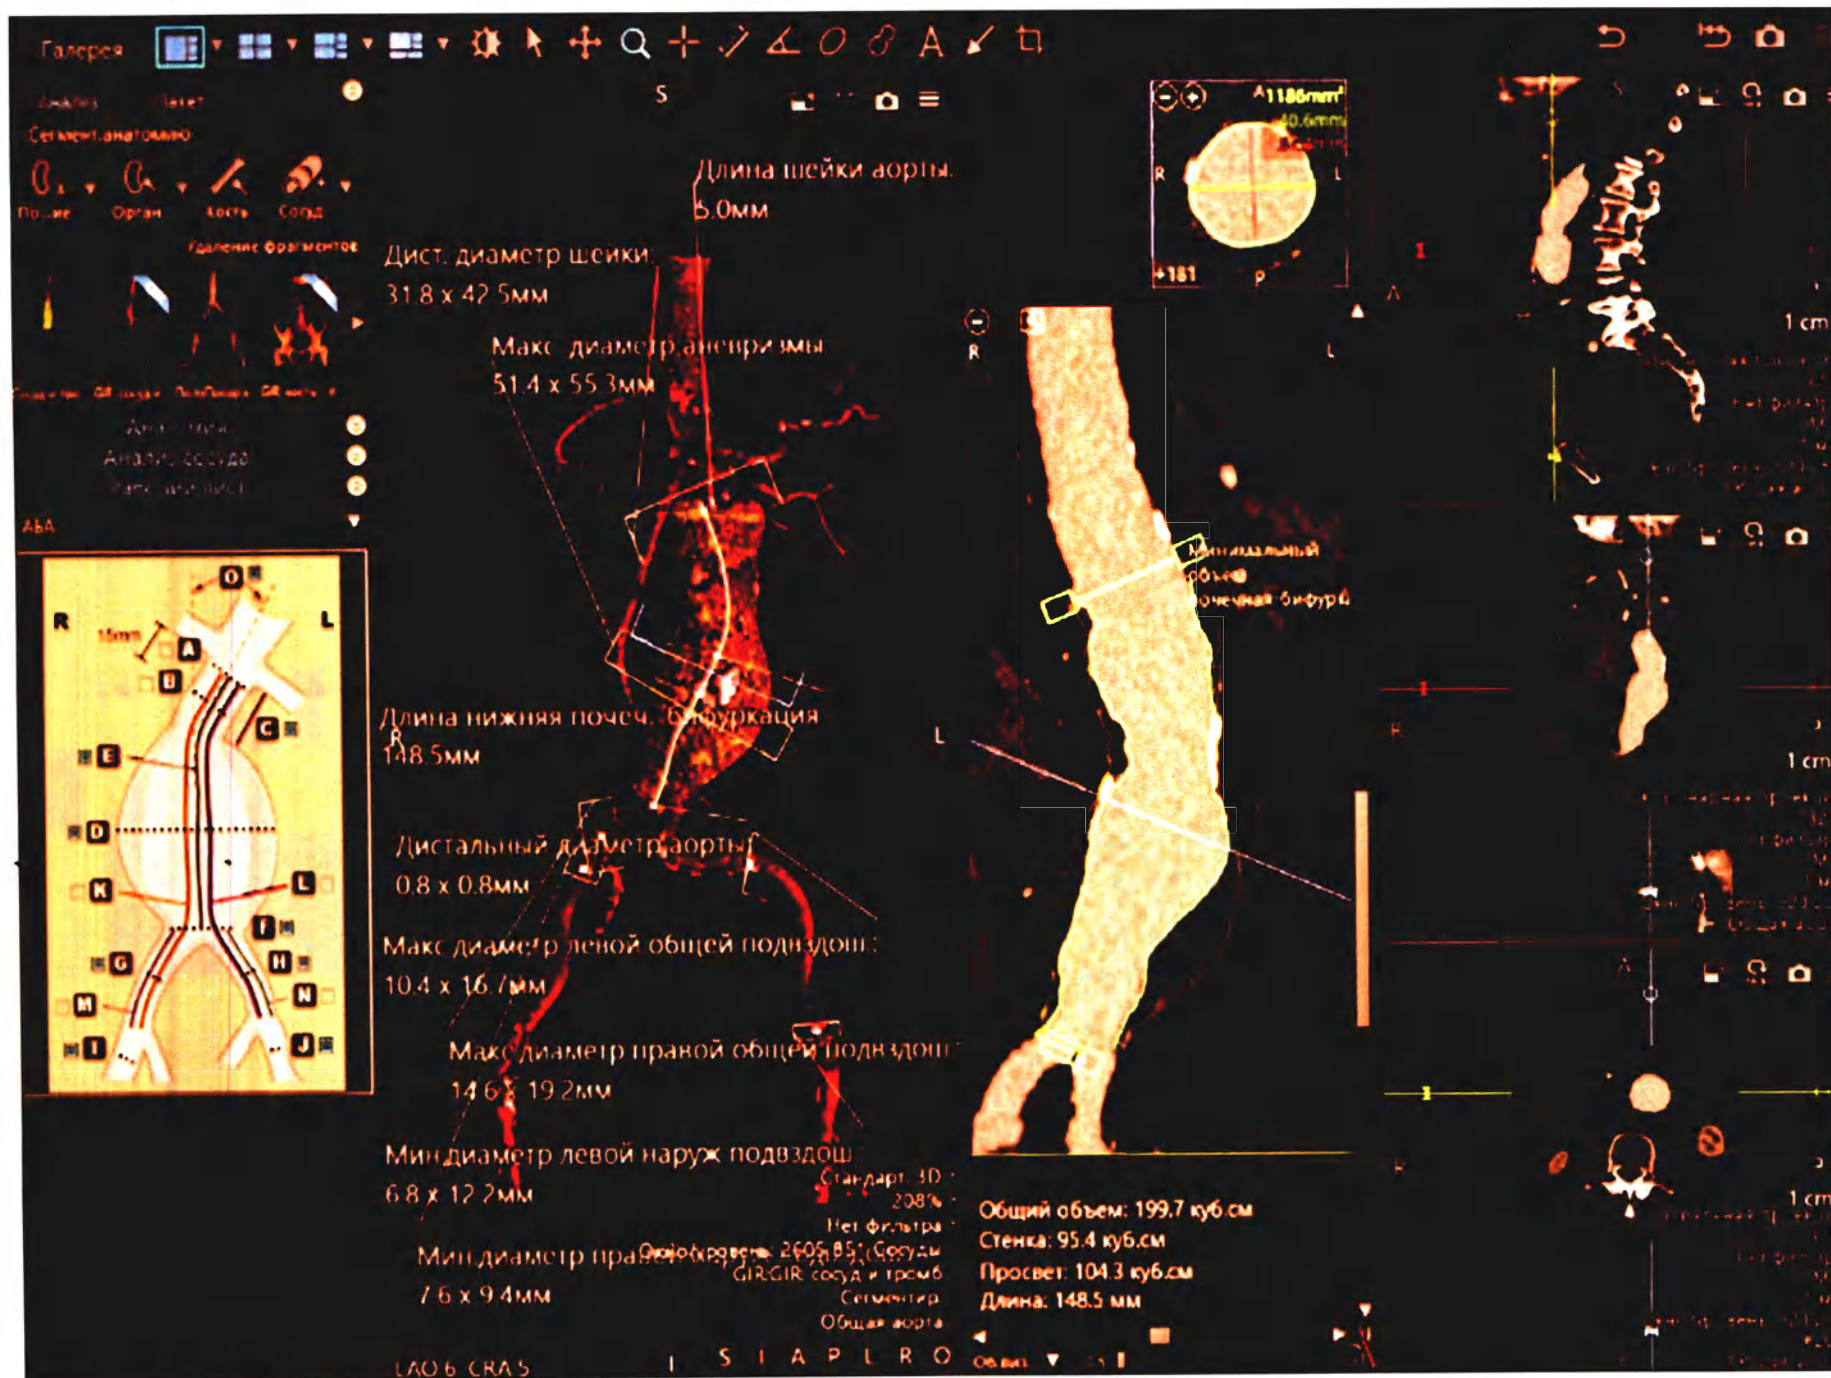


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

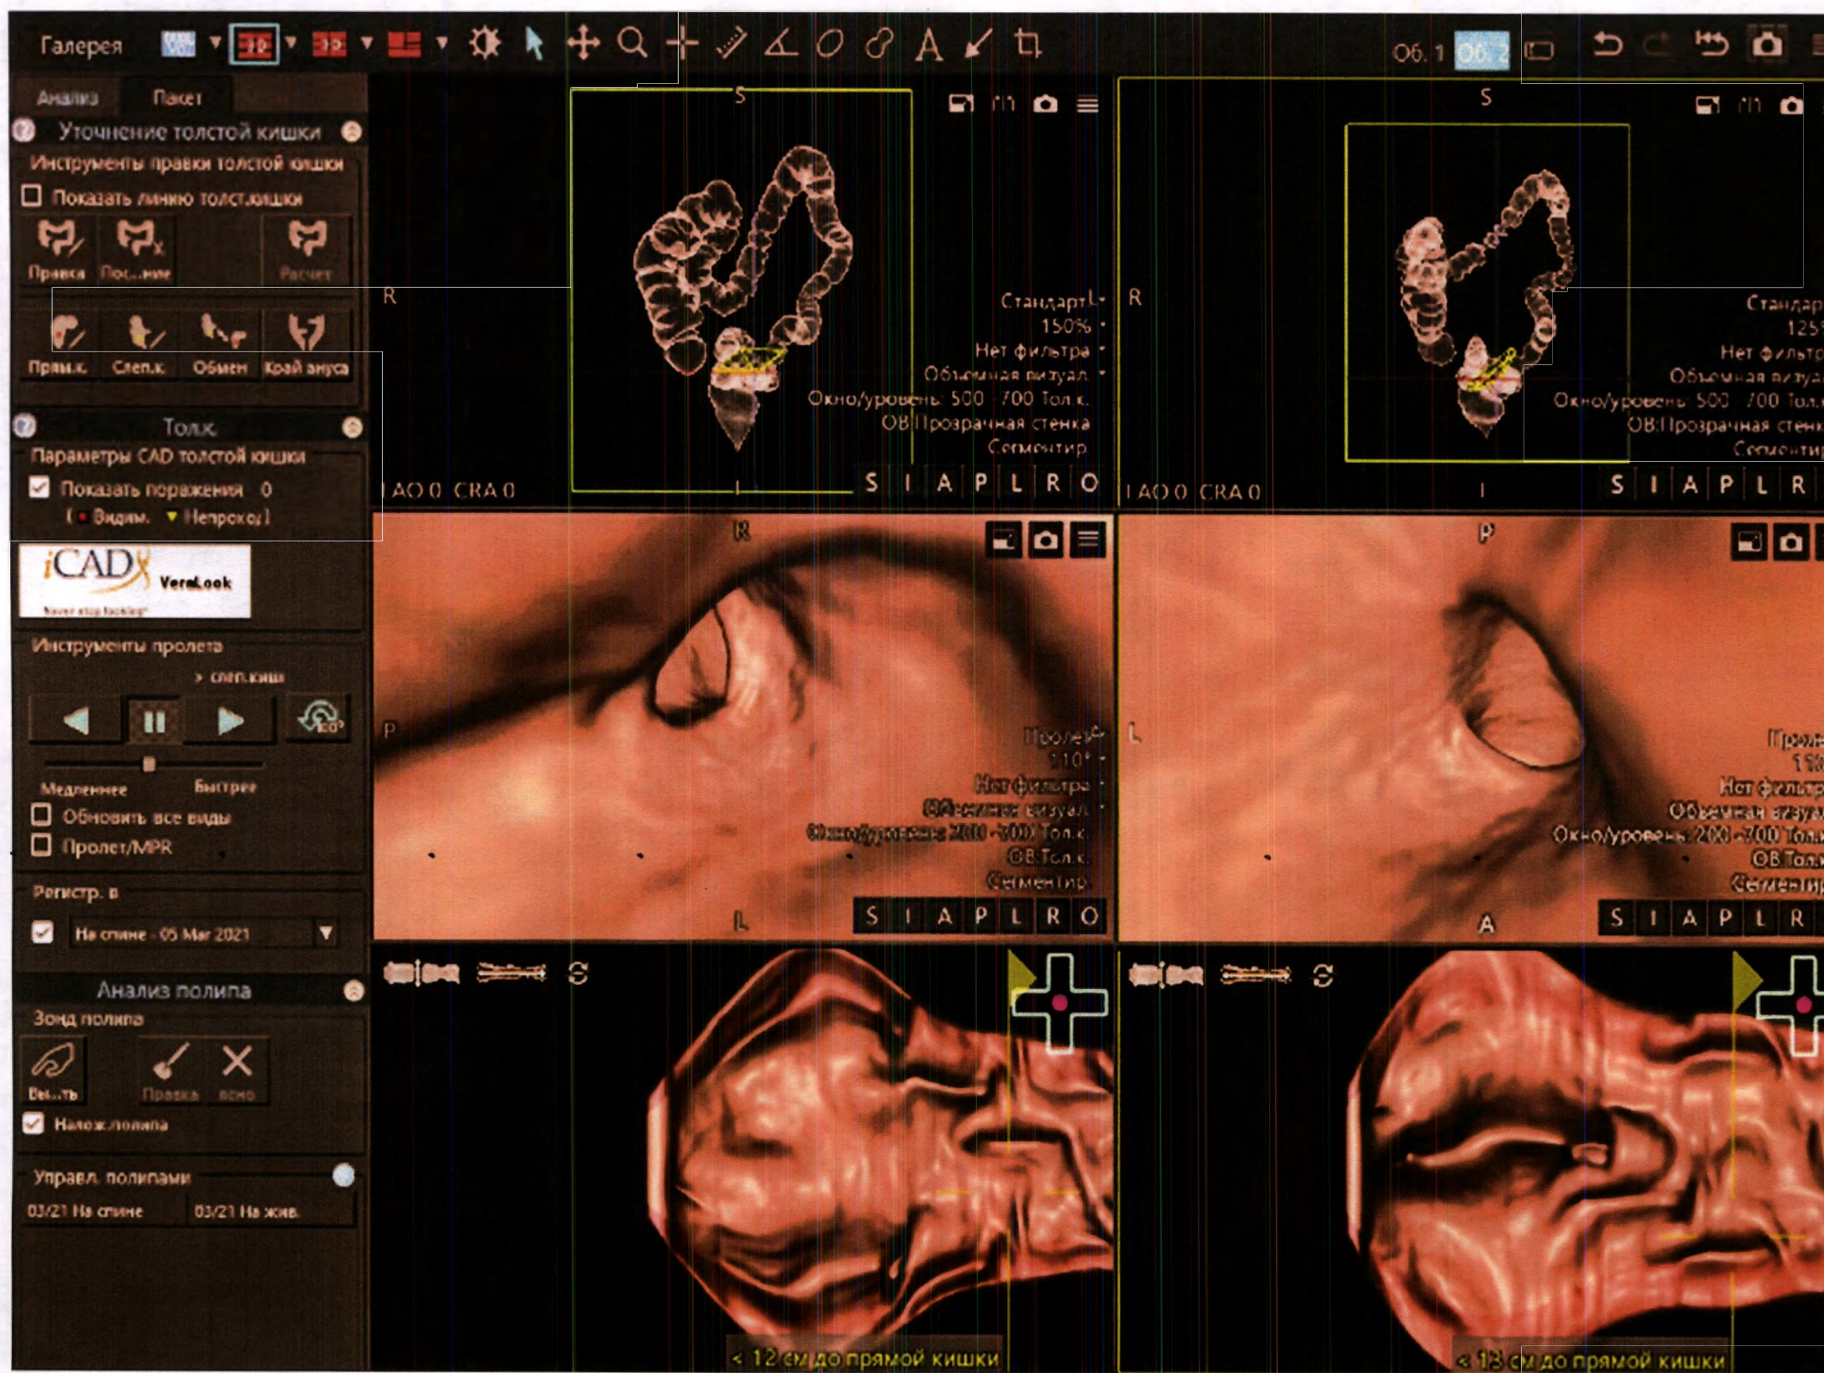


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для анализа перфузии головного мозга)

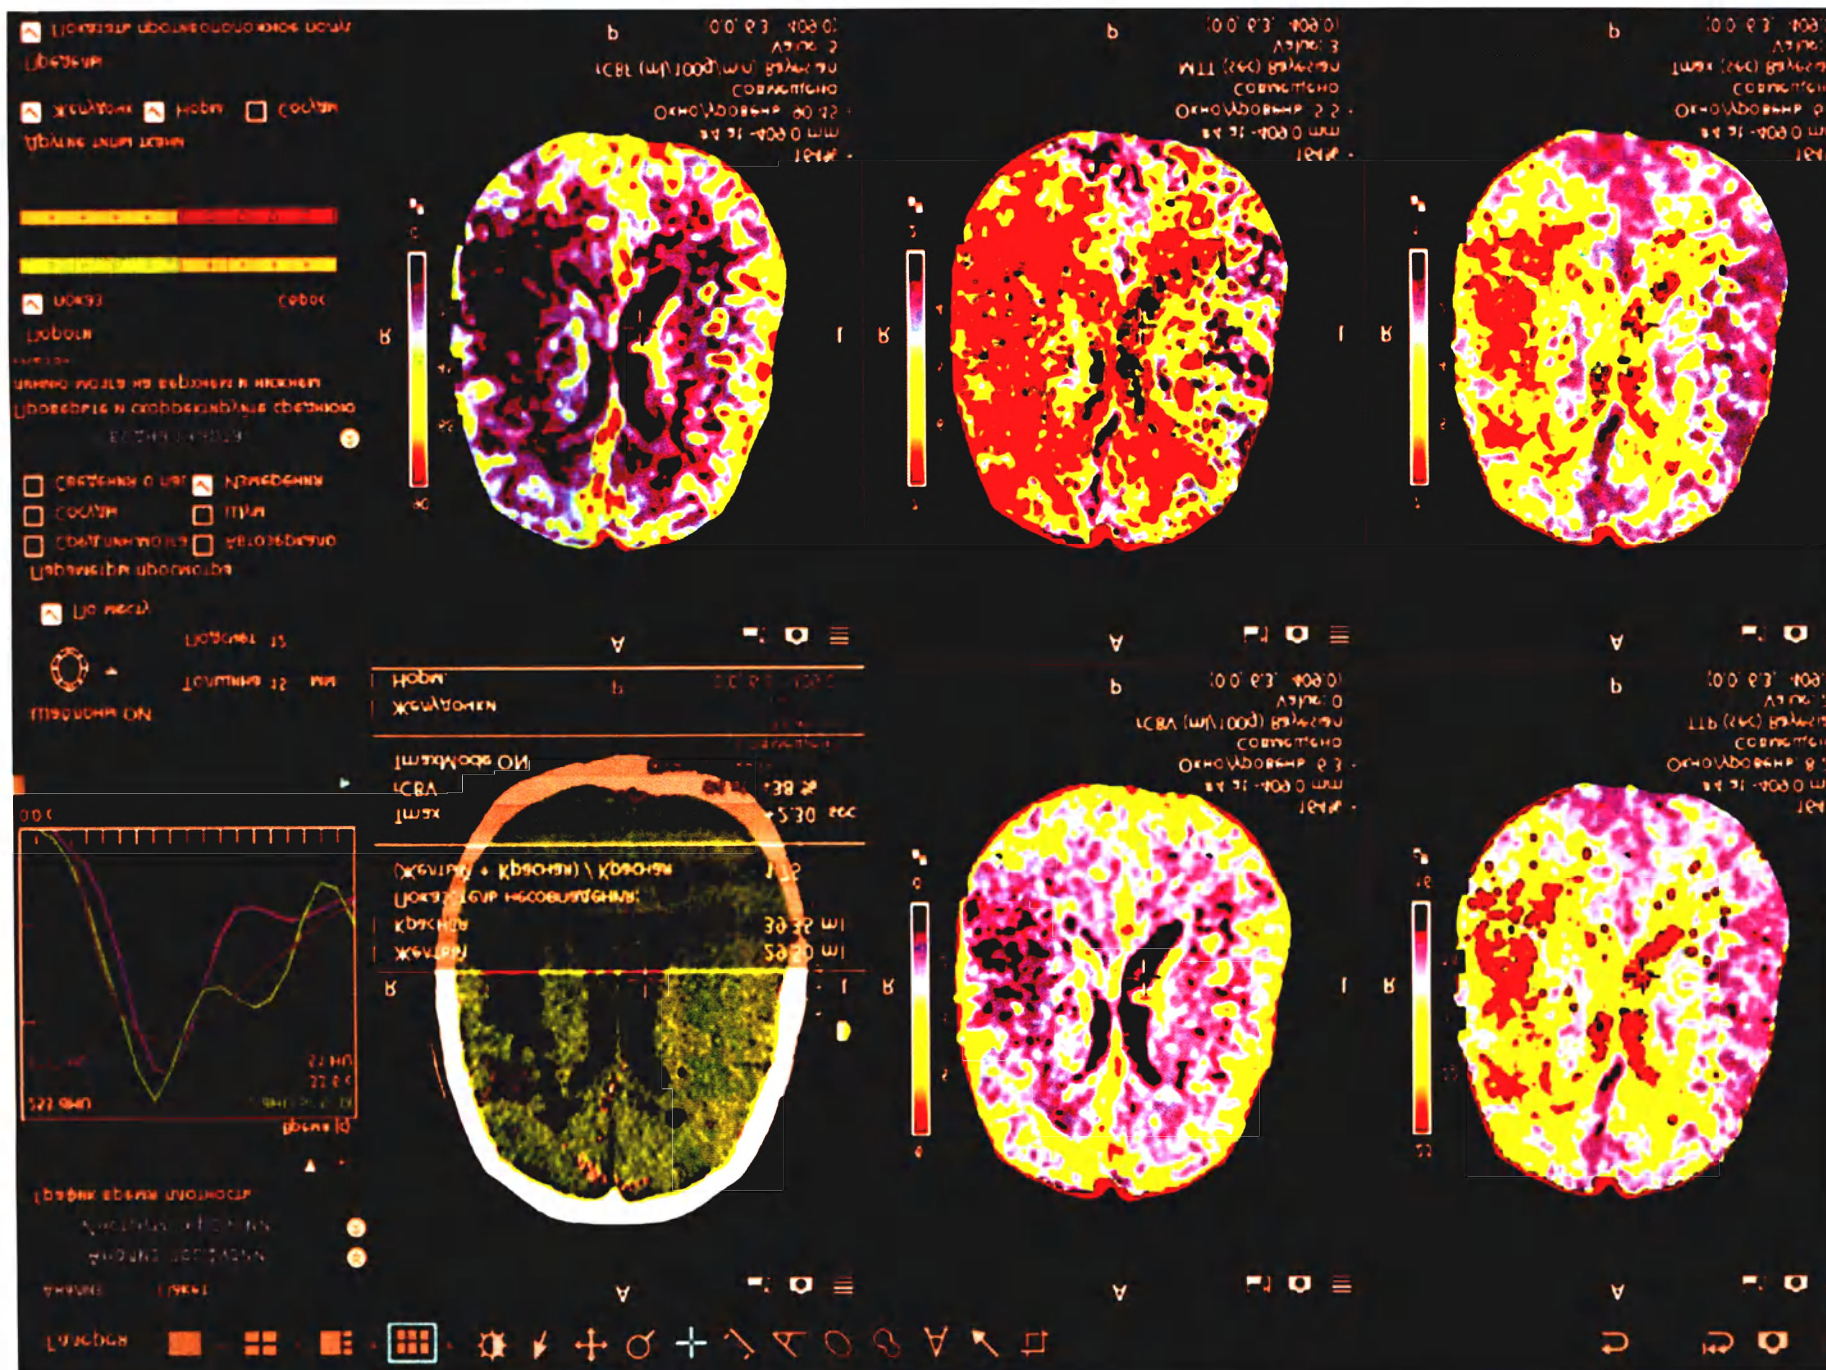


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

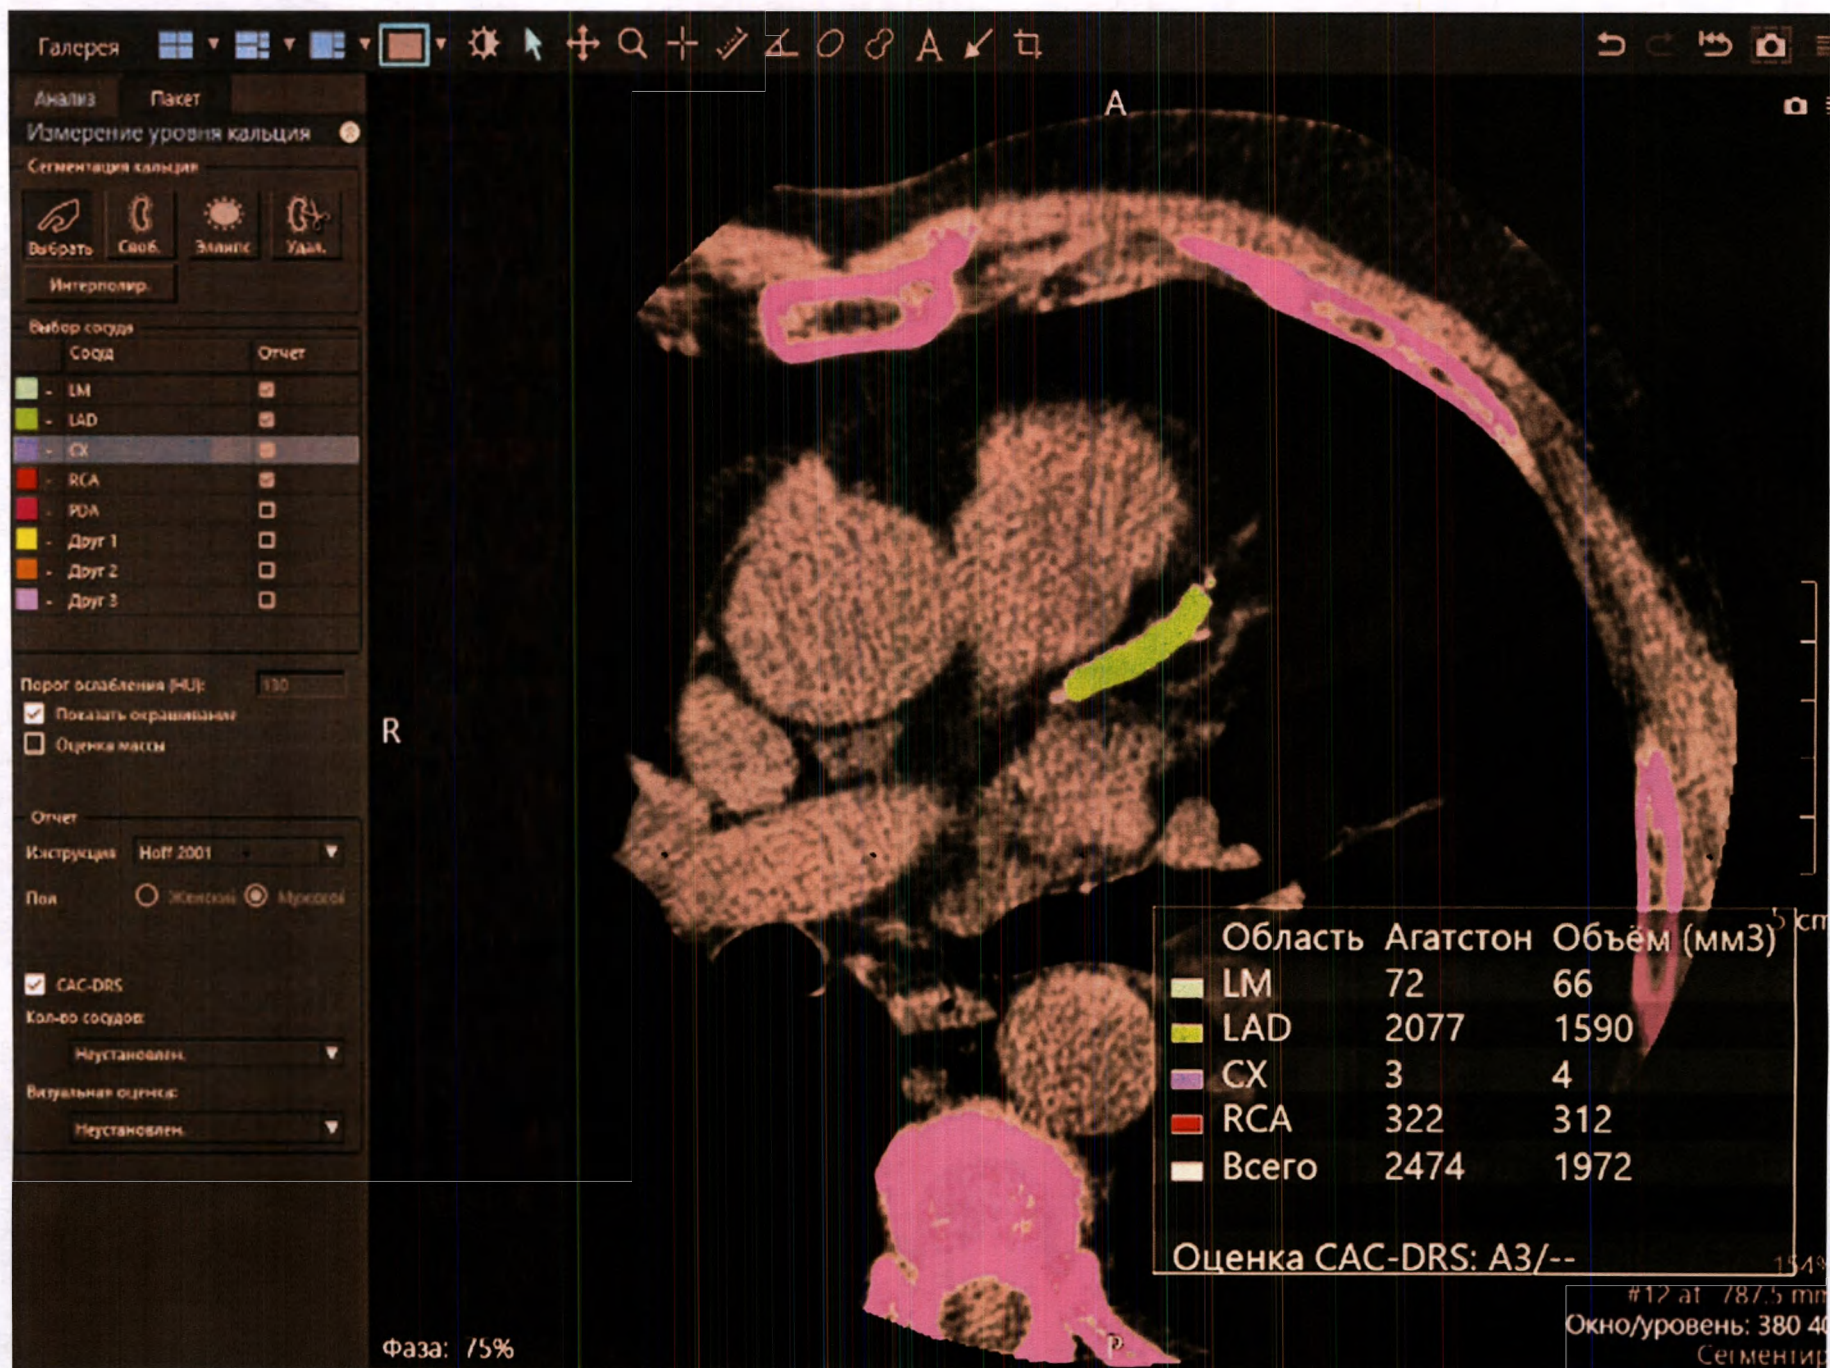


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов)

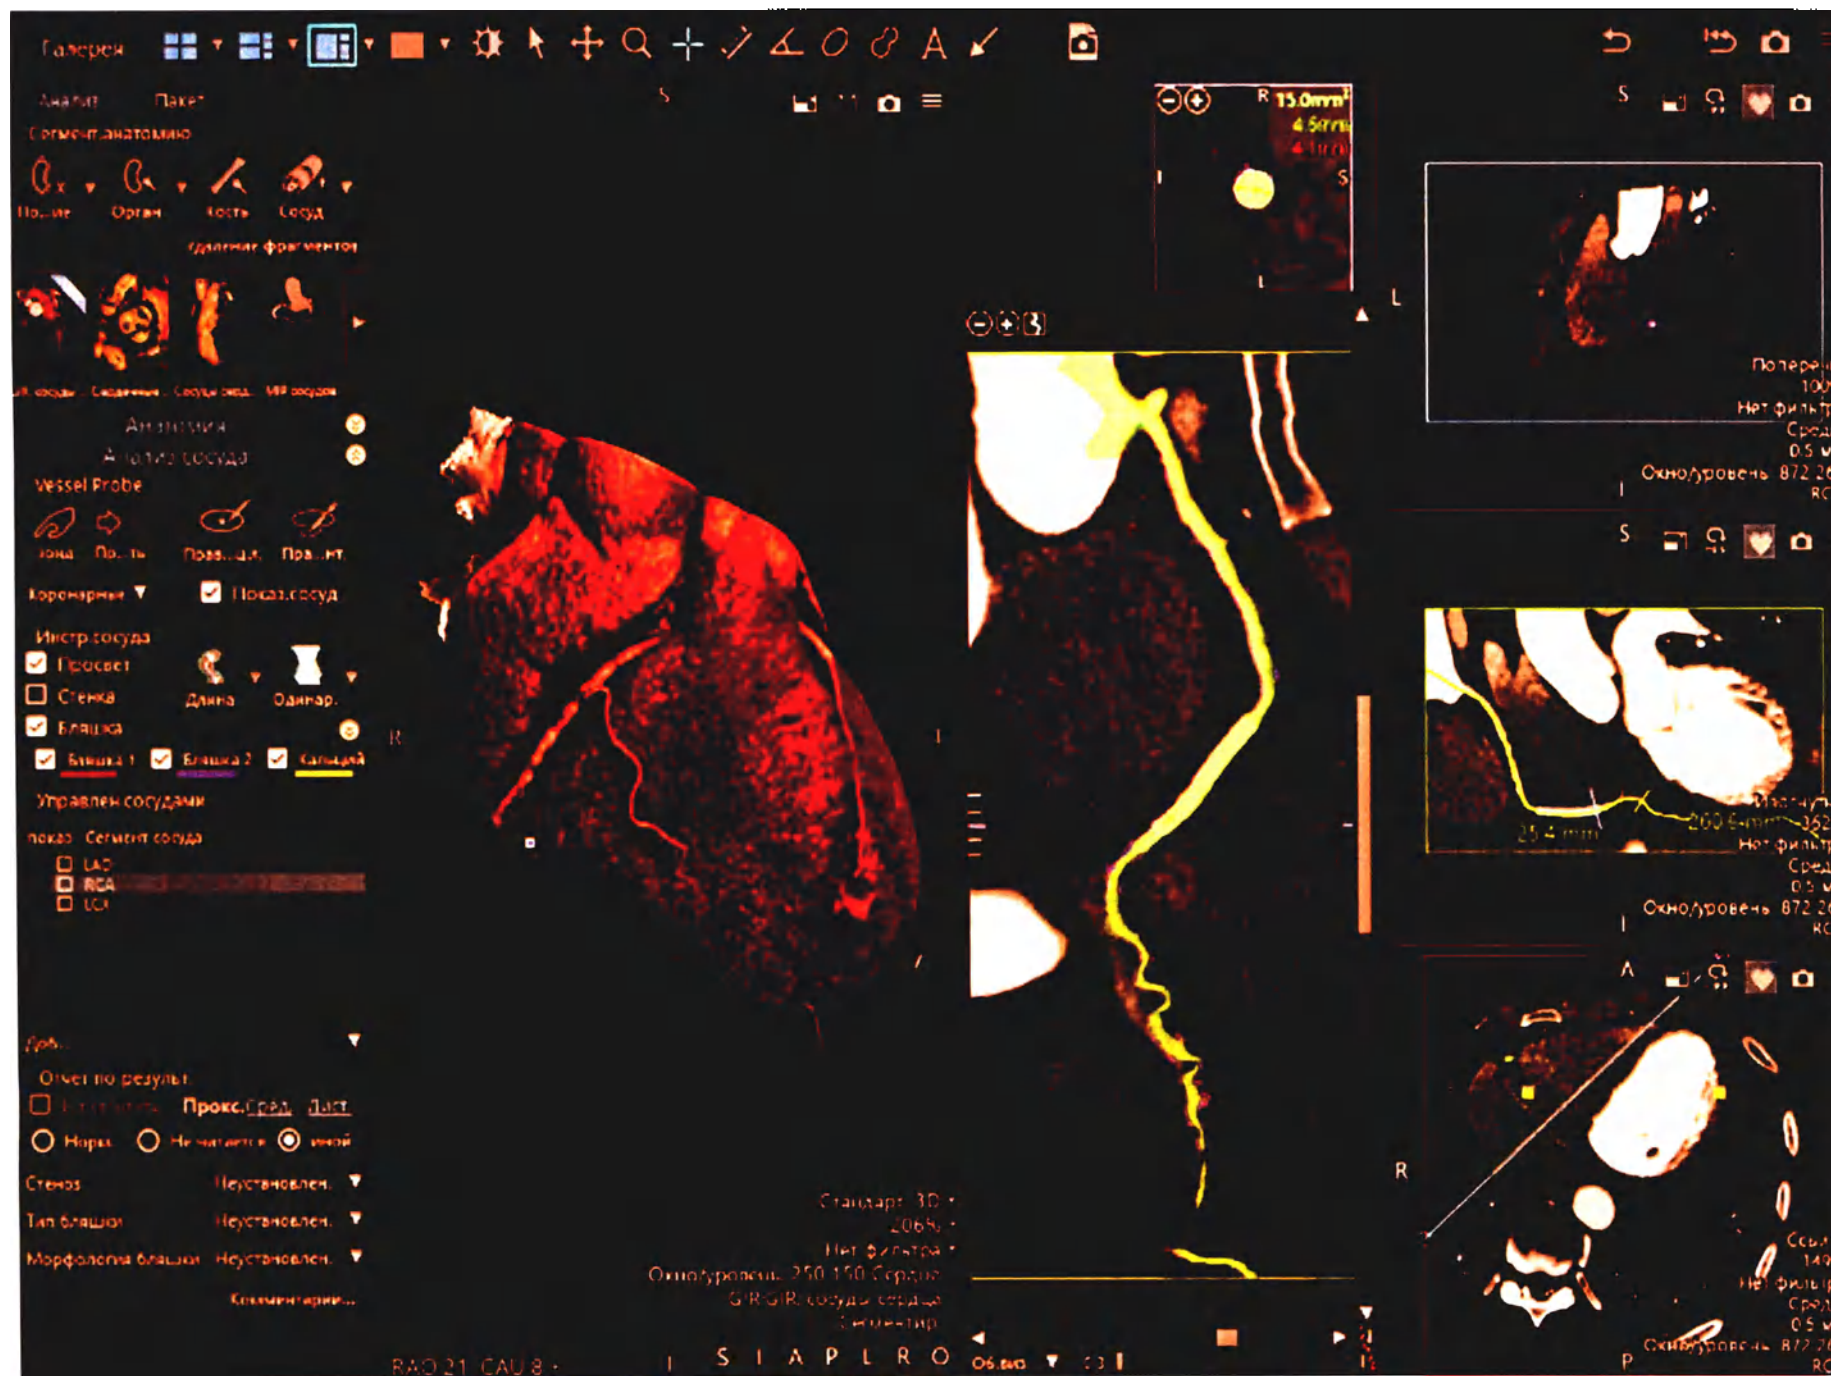


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

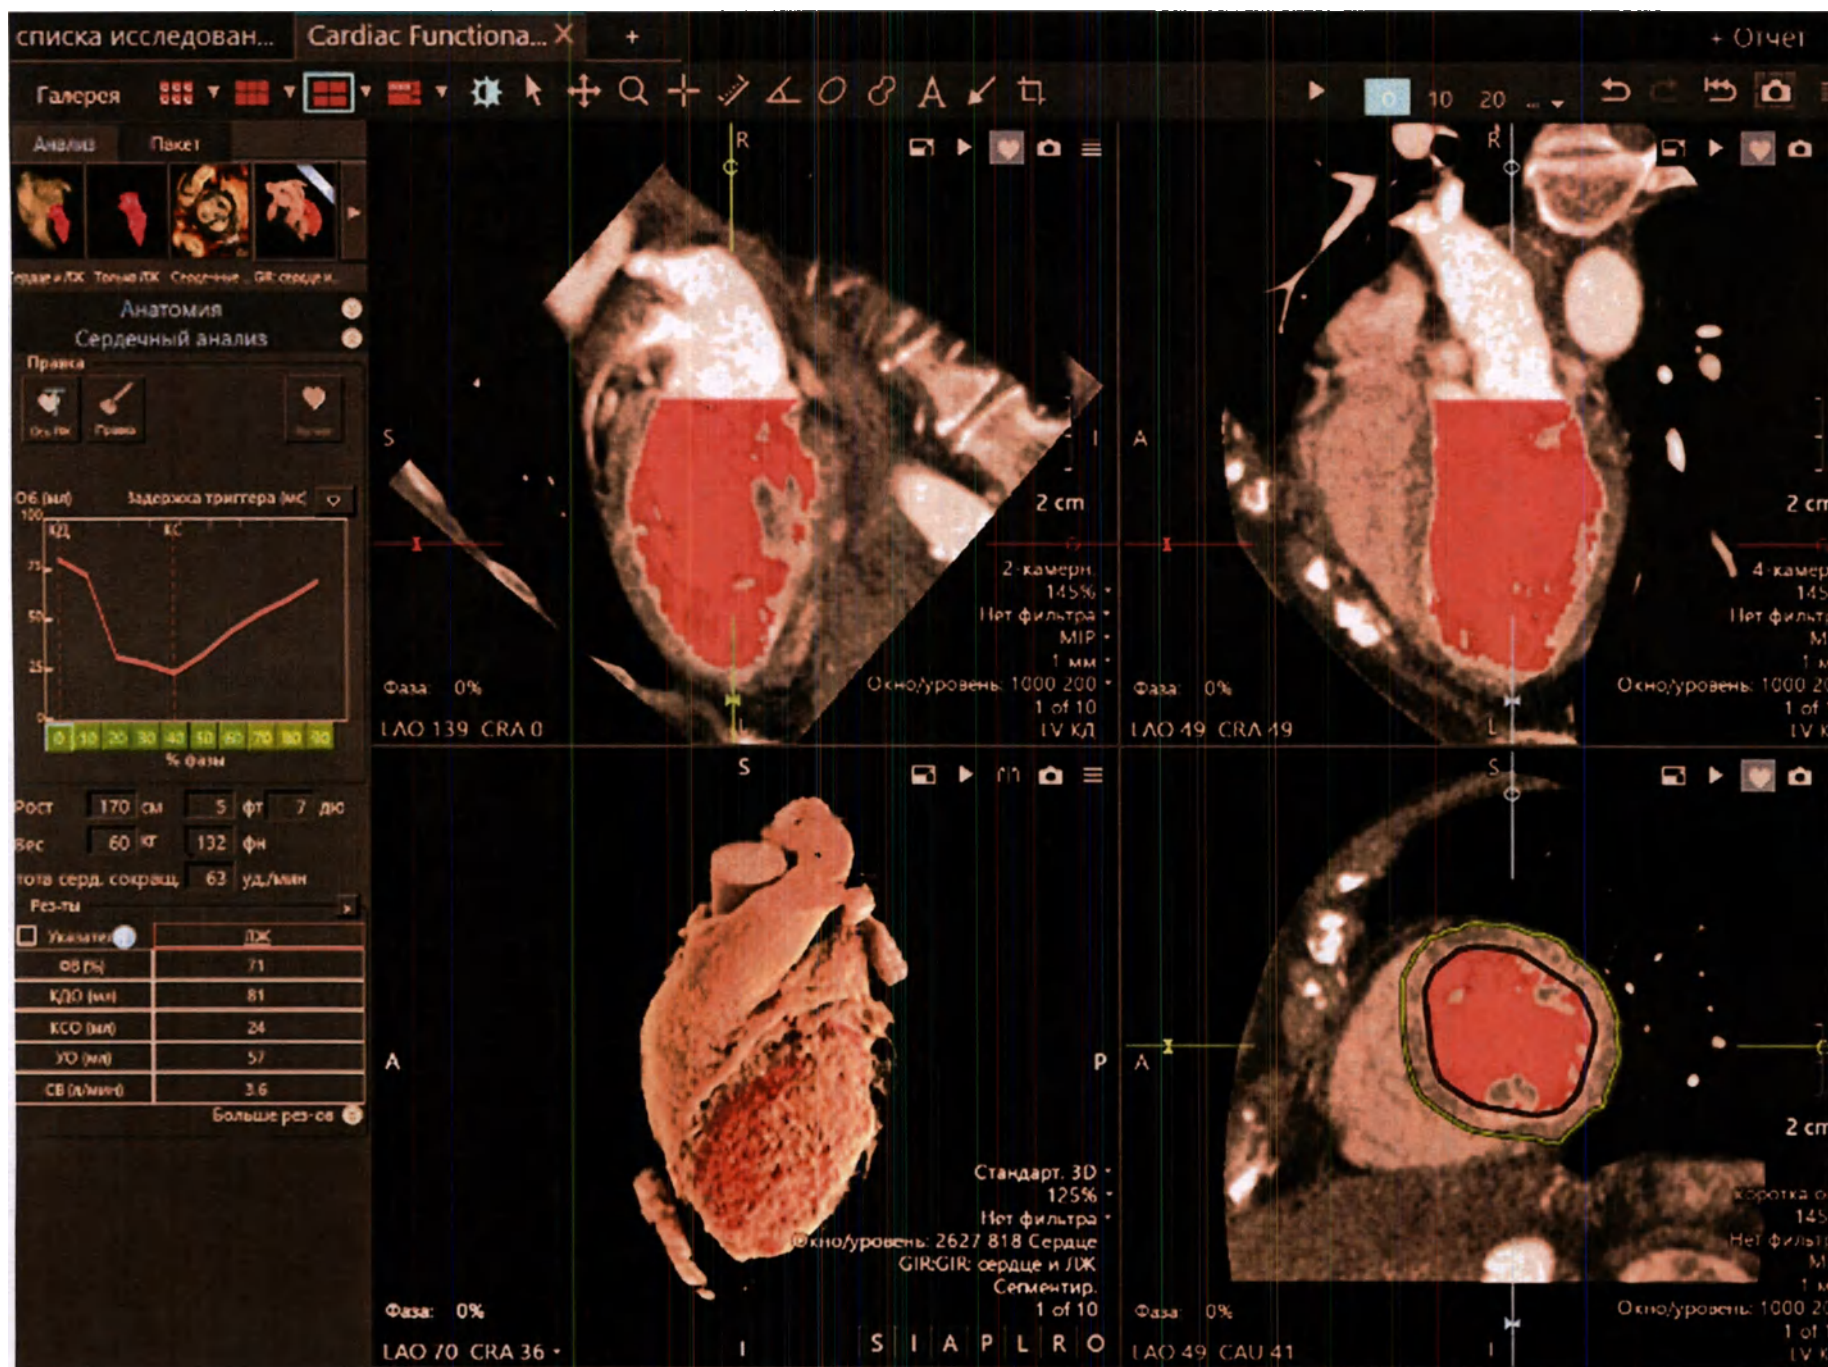


19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек)

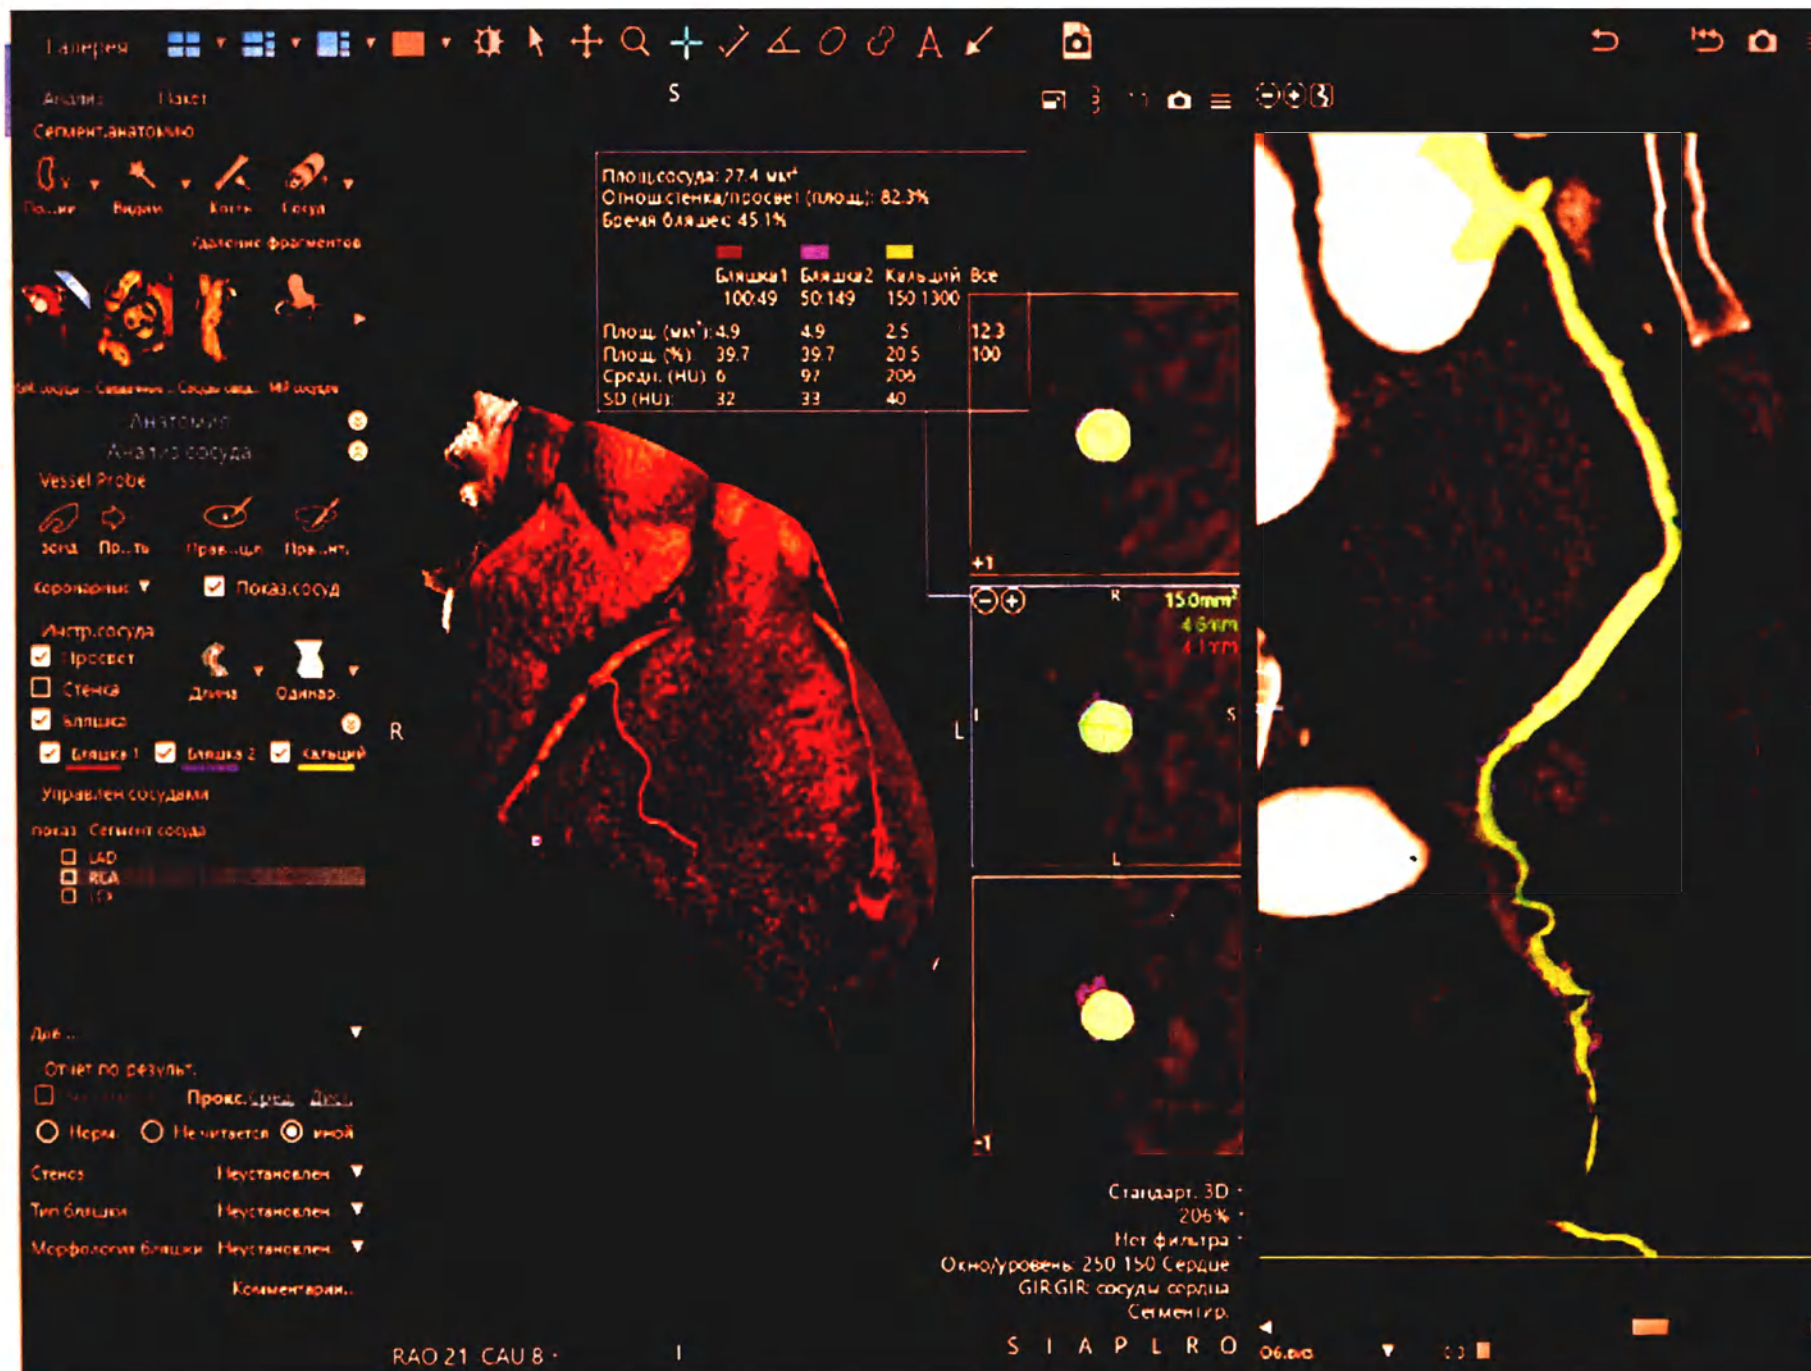

19. Программный пакет Vitrea CT Package №4 (при необходимости) (Приложение для анализа объемных данных перфузии головного мозга)

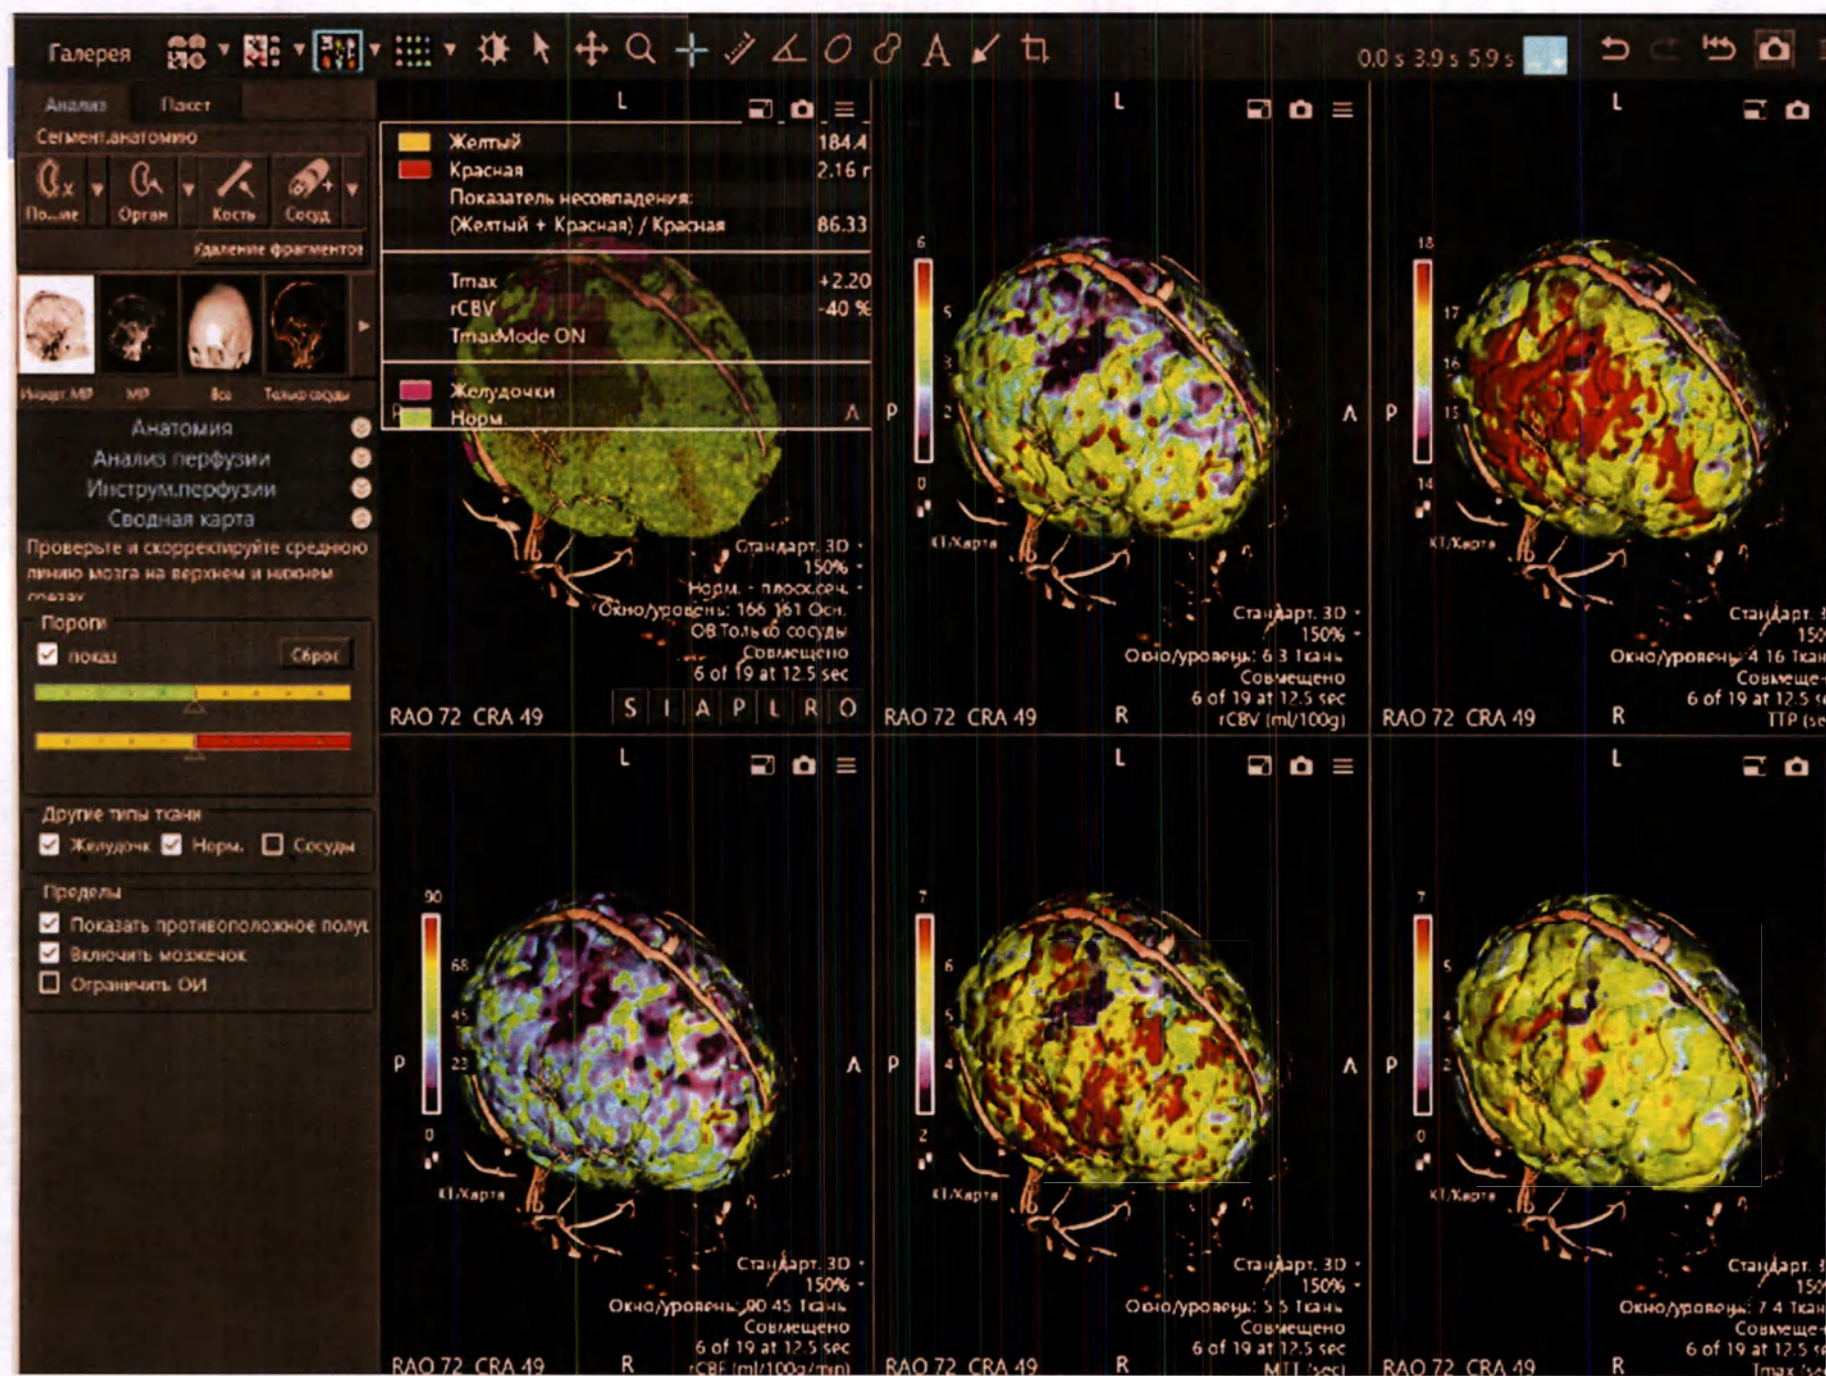


20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

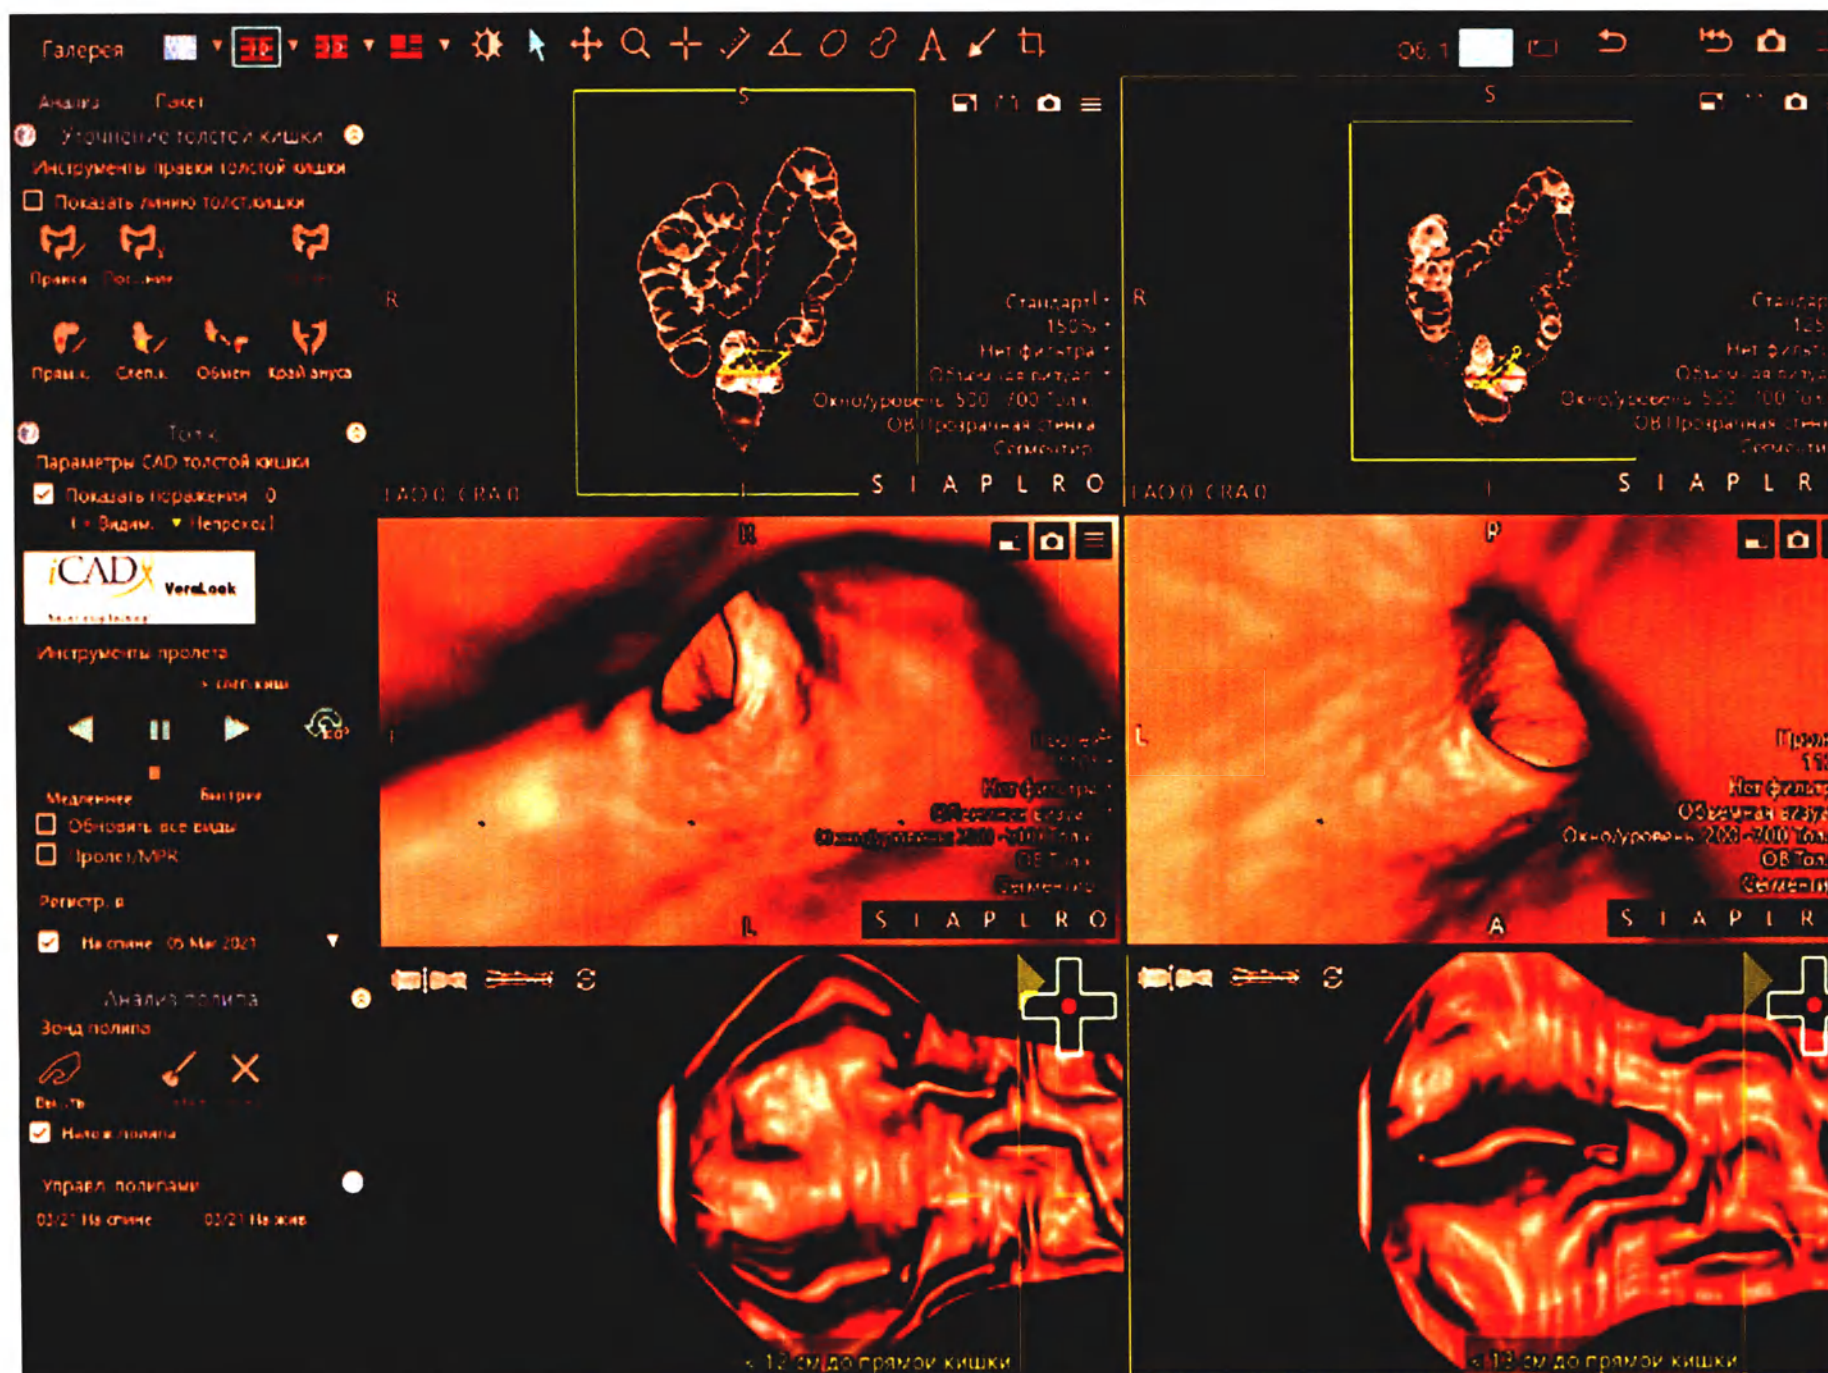


20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)




20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа плотности легочной ткани)

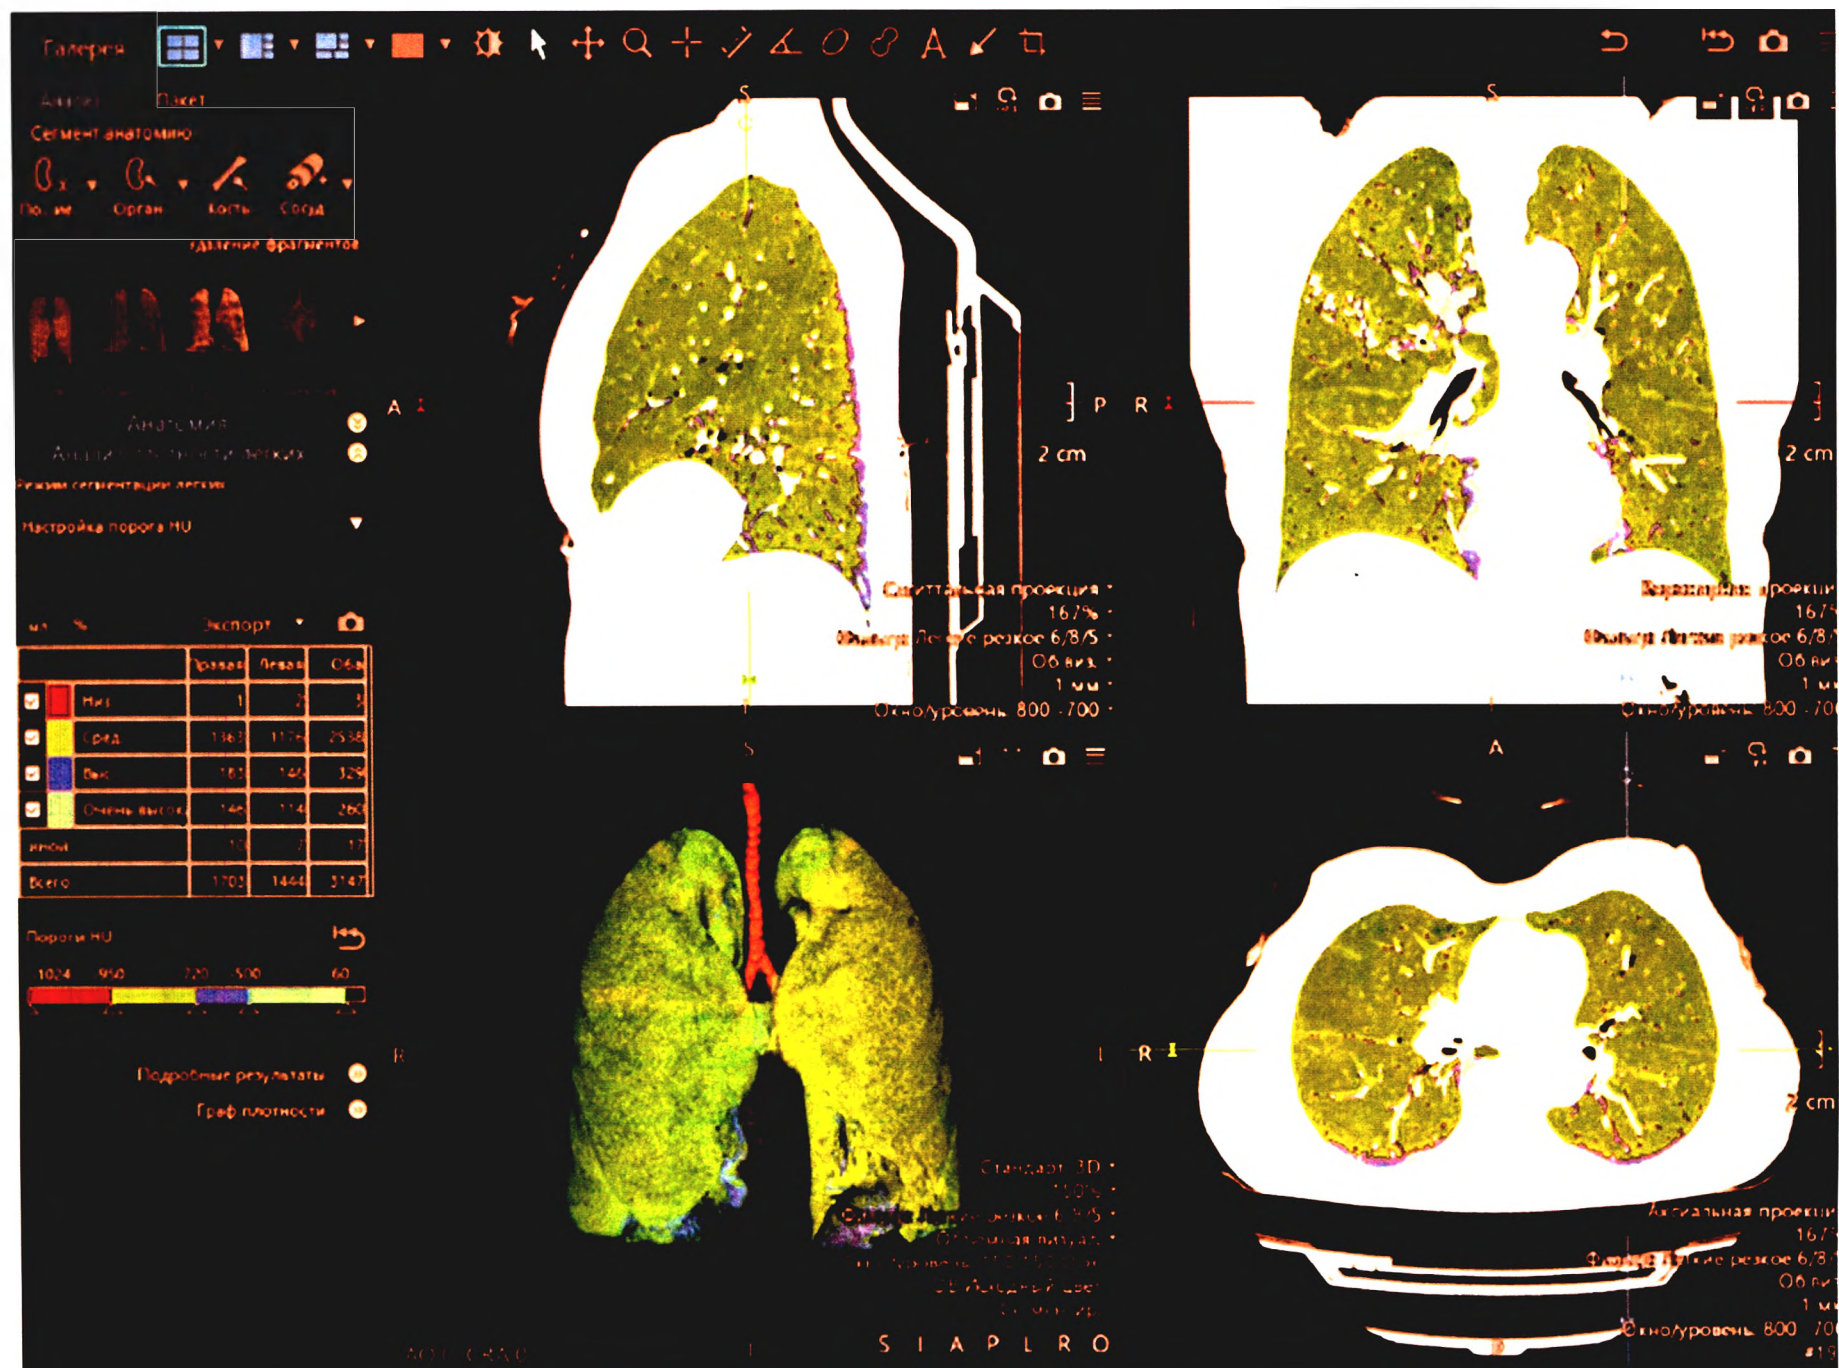


20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

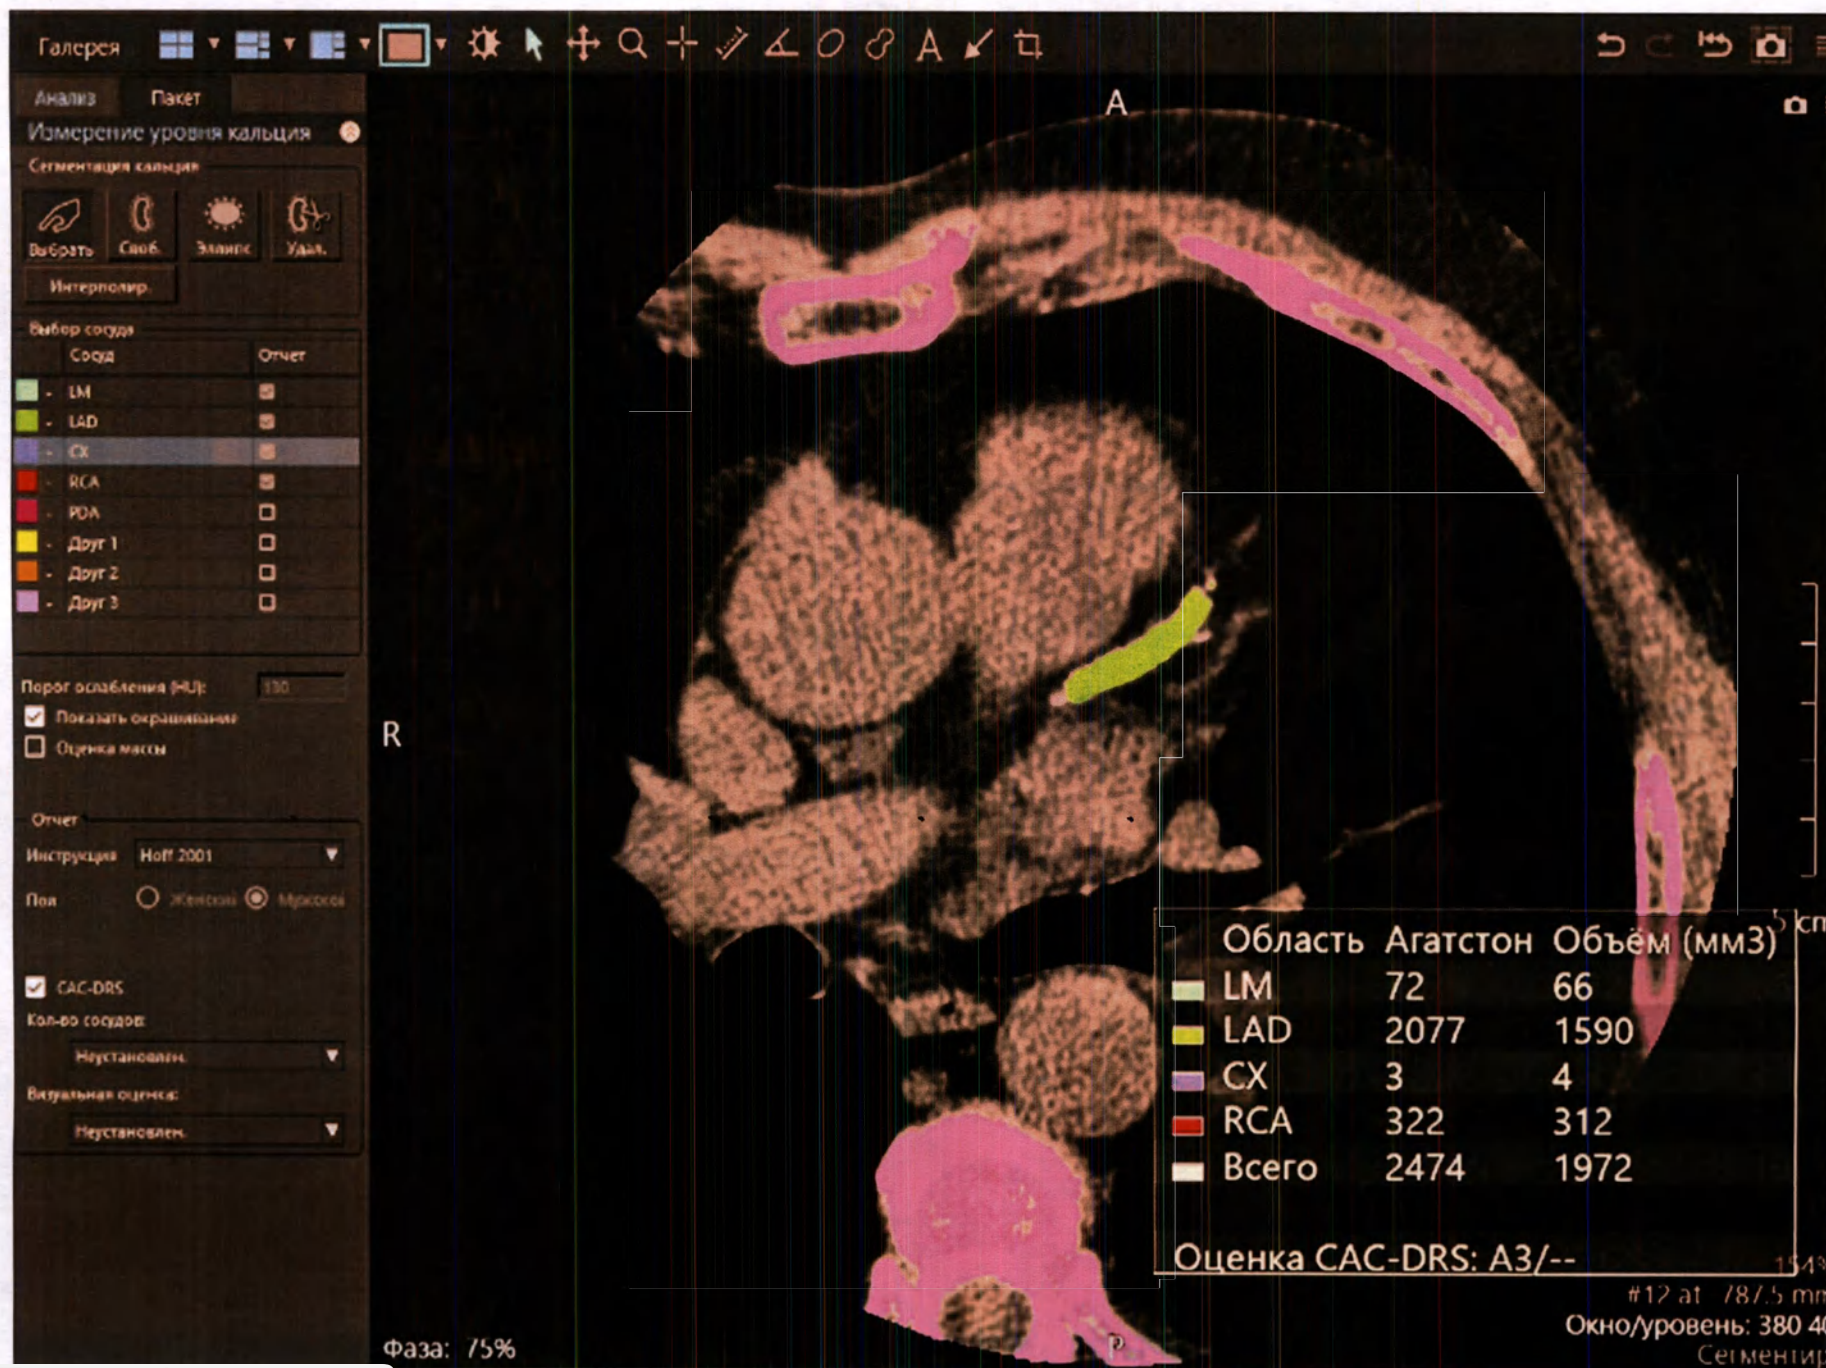


20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов)

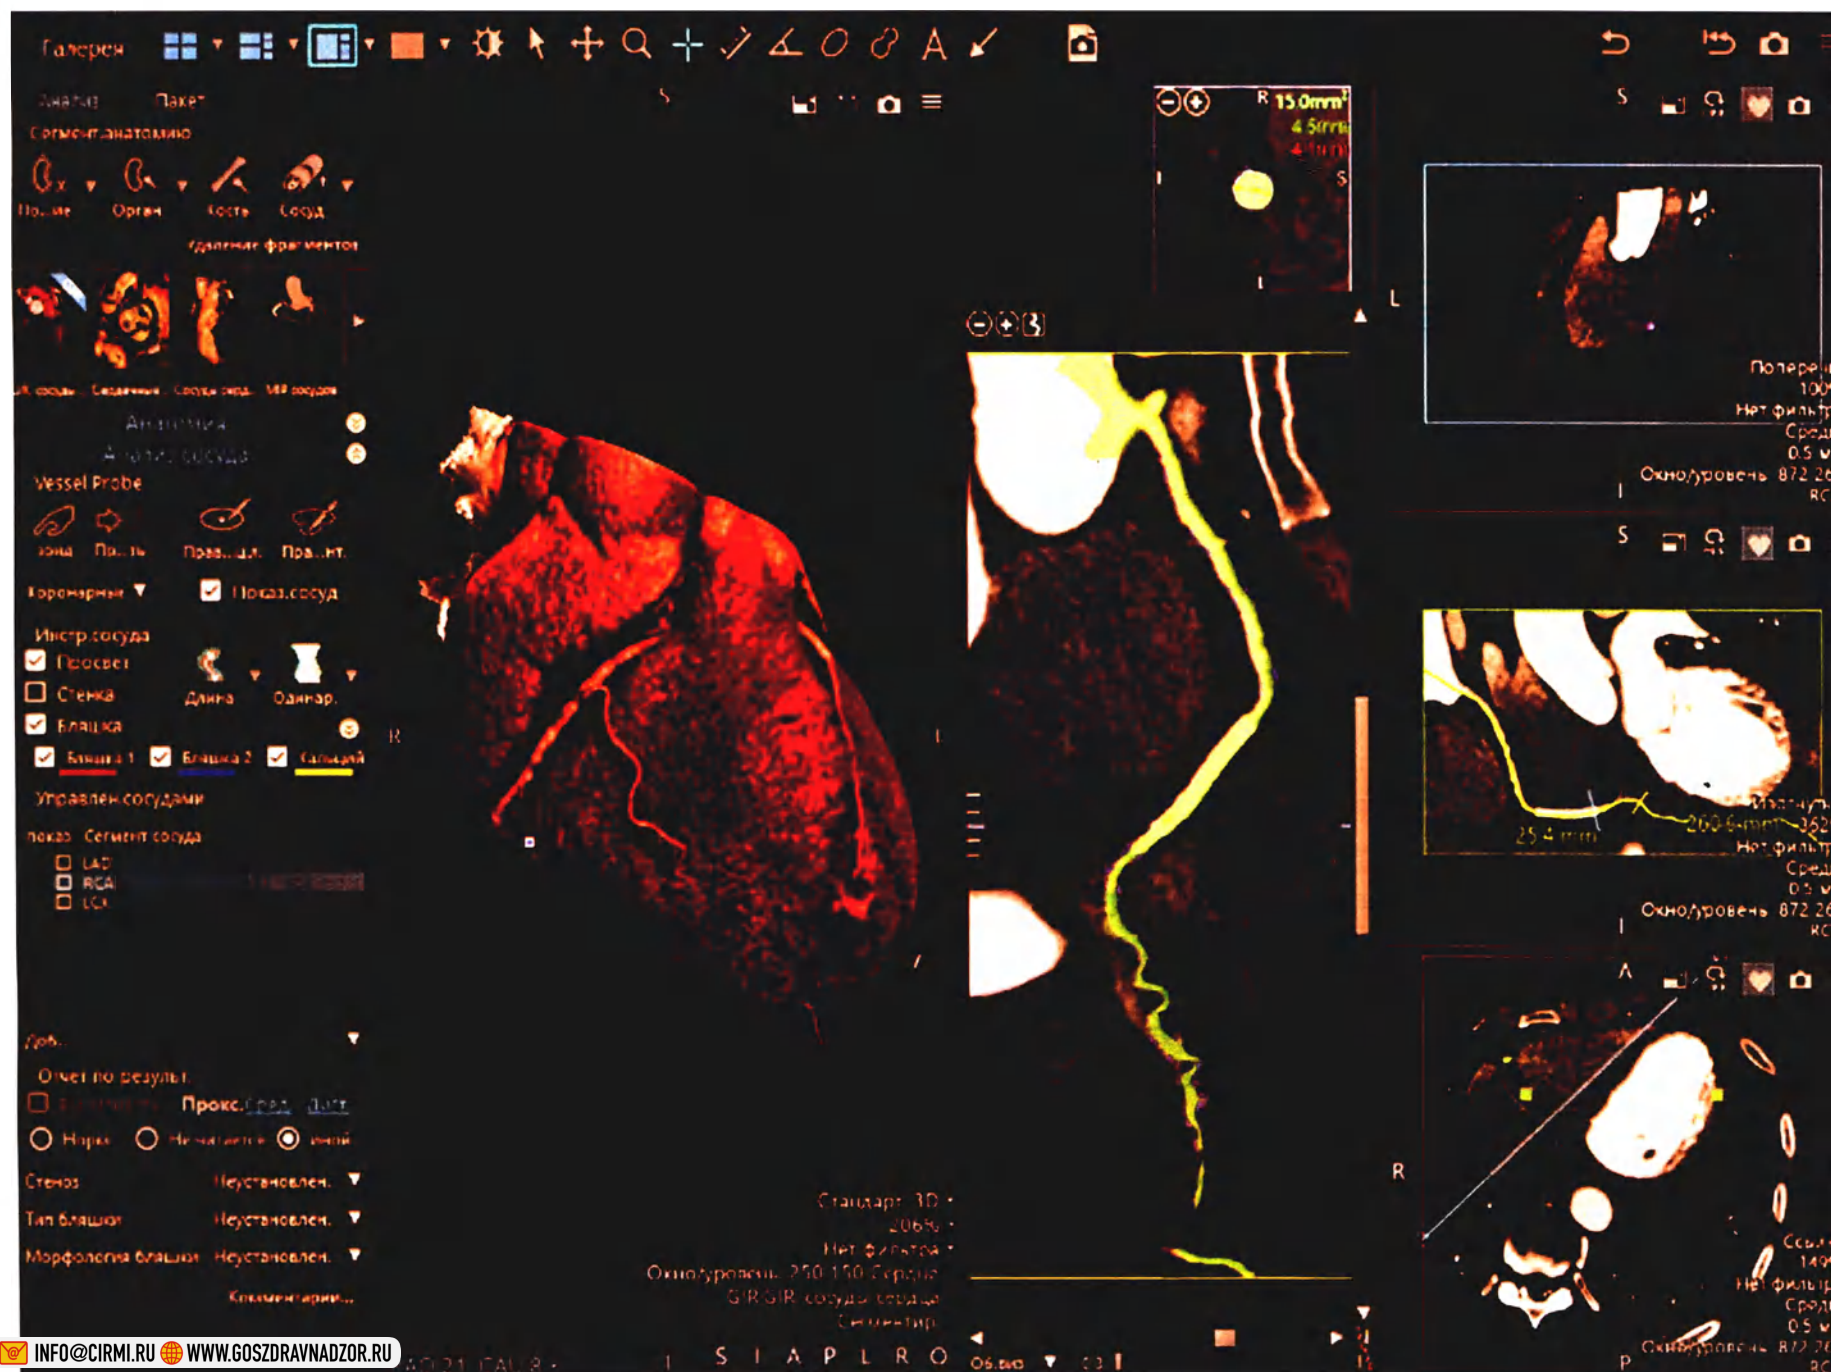


20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

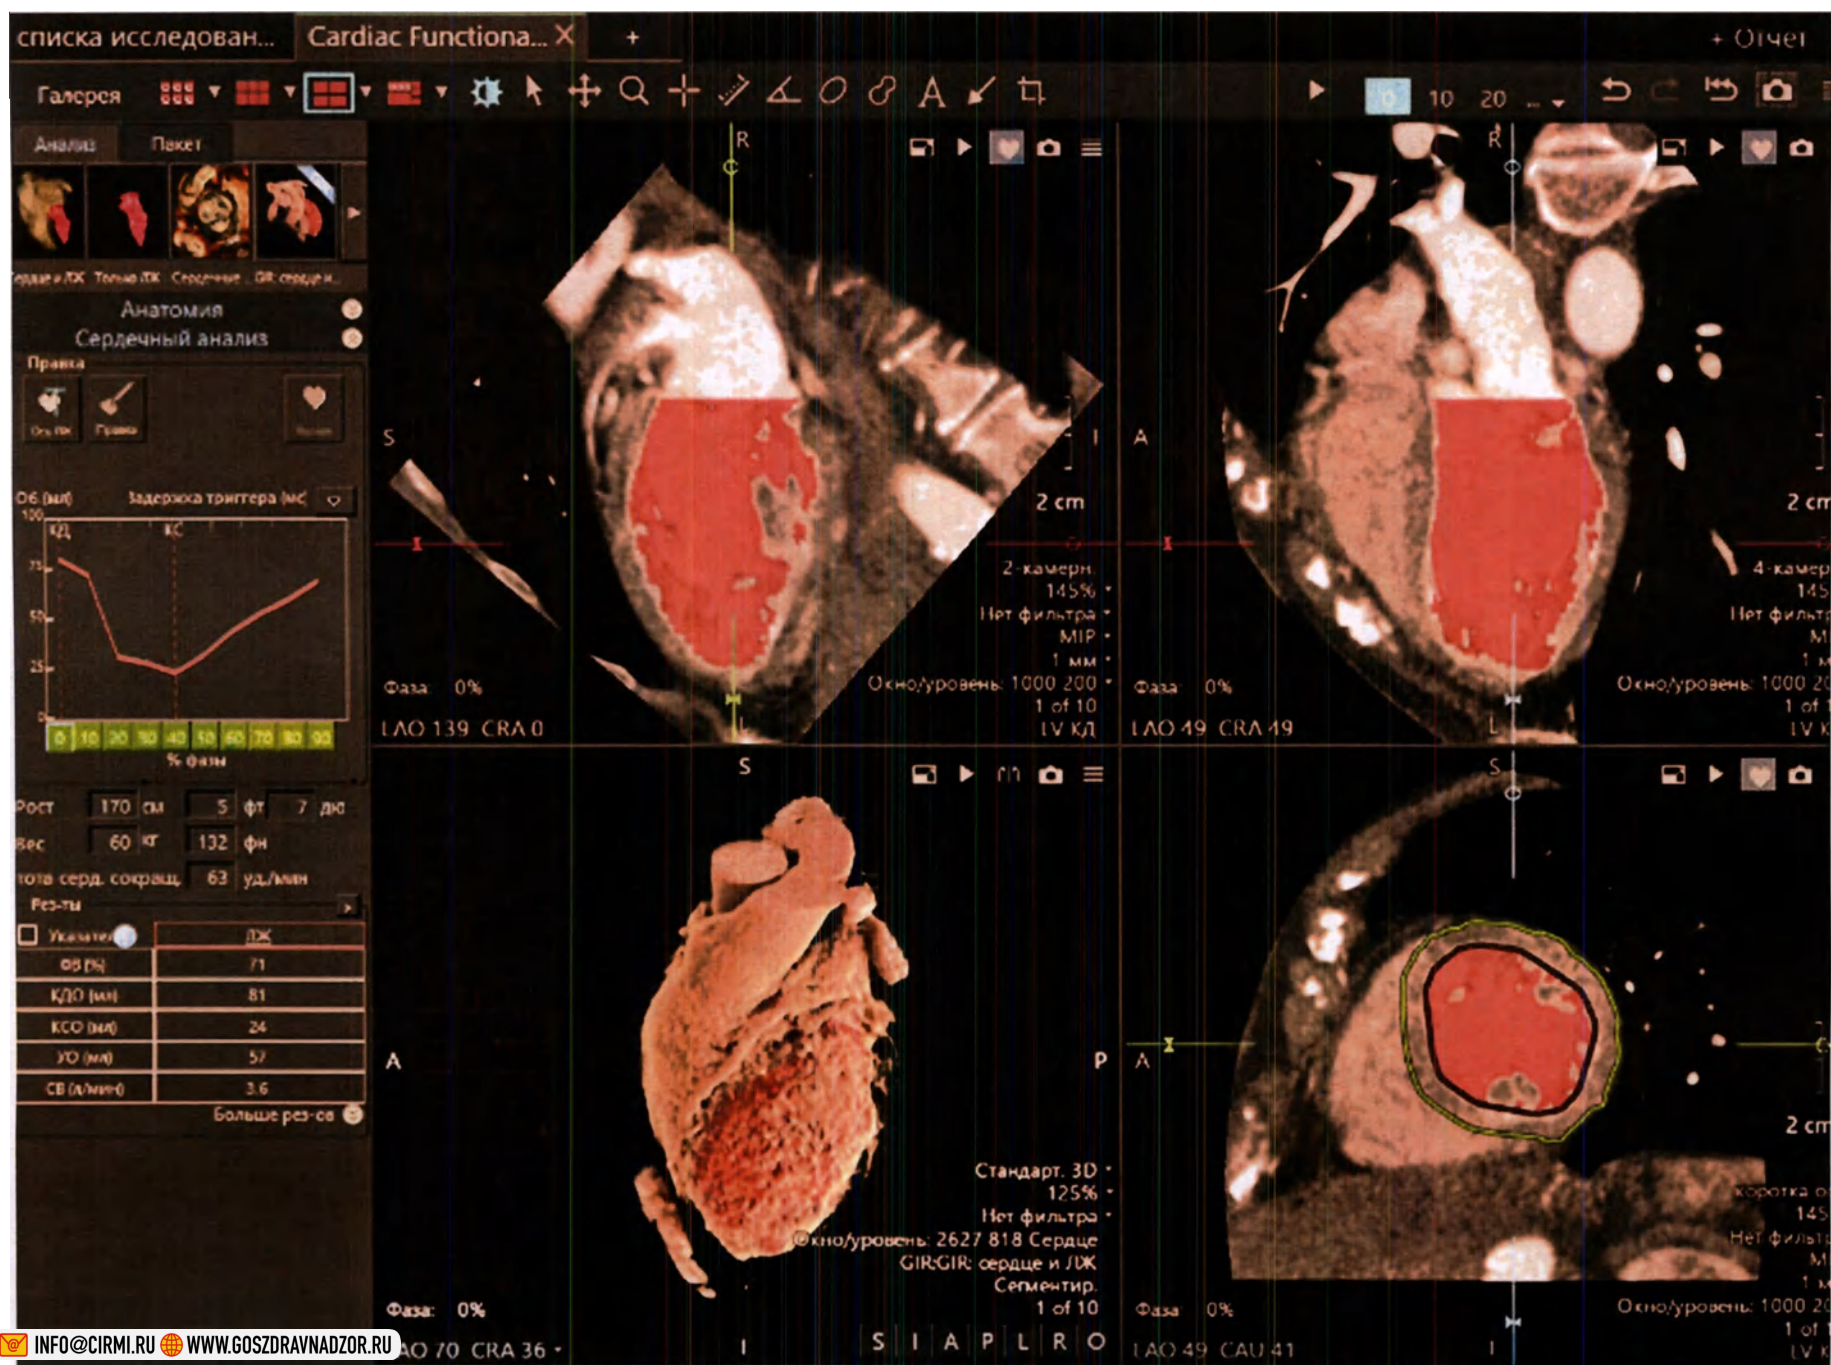

20. Программный пакет Vitrea CT Package №1 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для улучшения качества изображений)

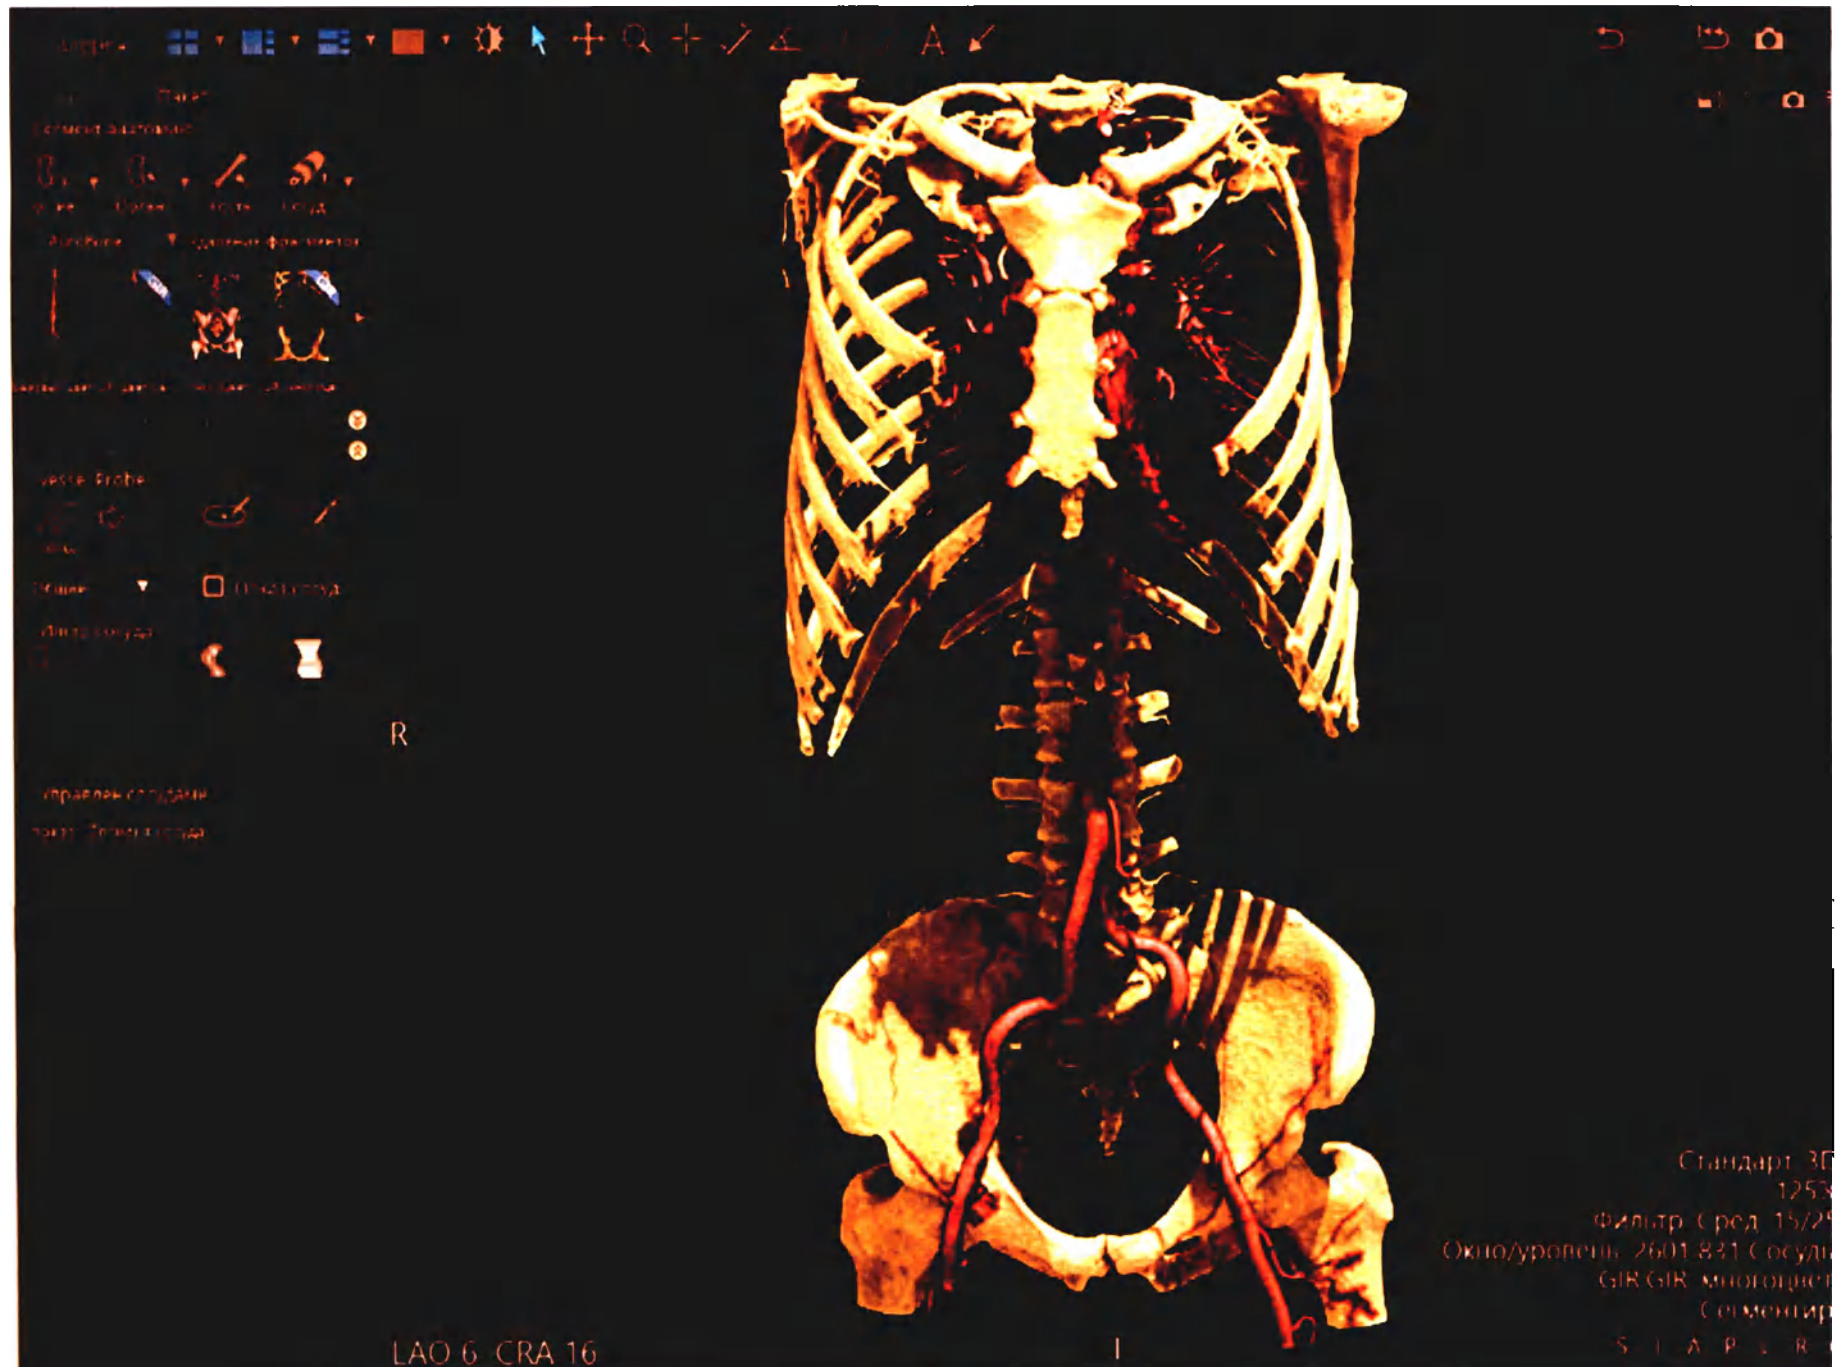


21. Программный пакет Vitrea CT Package №3 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

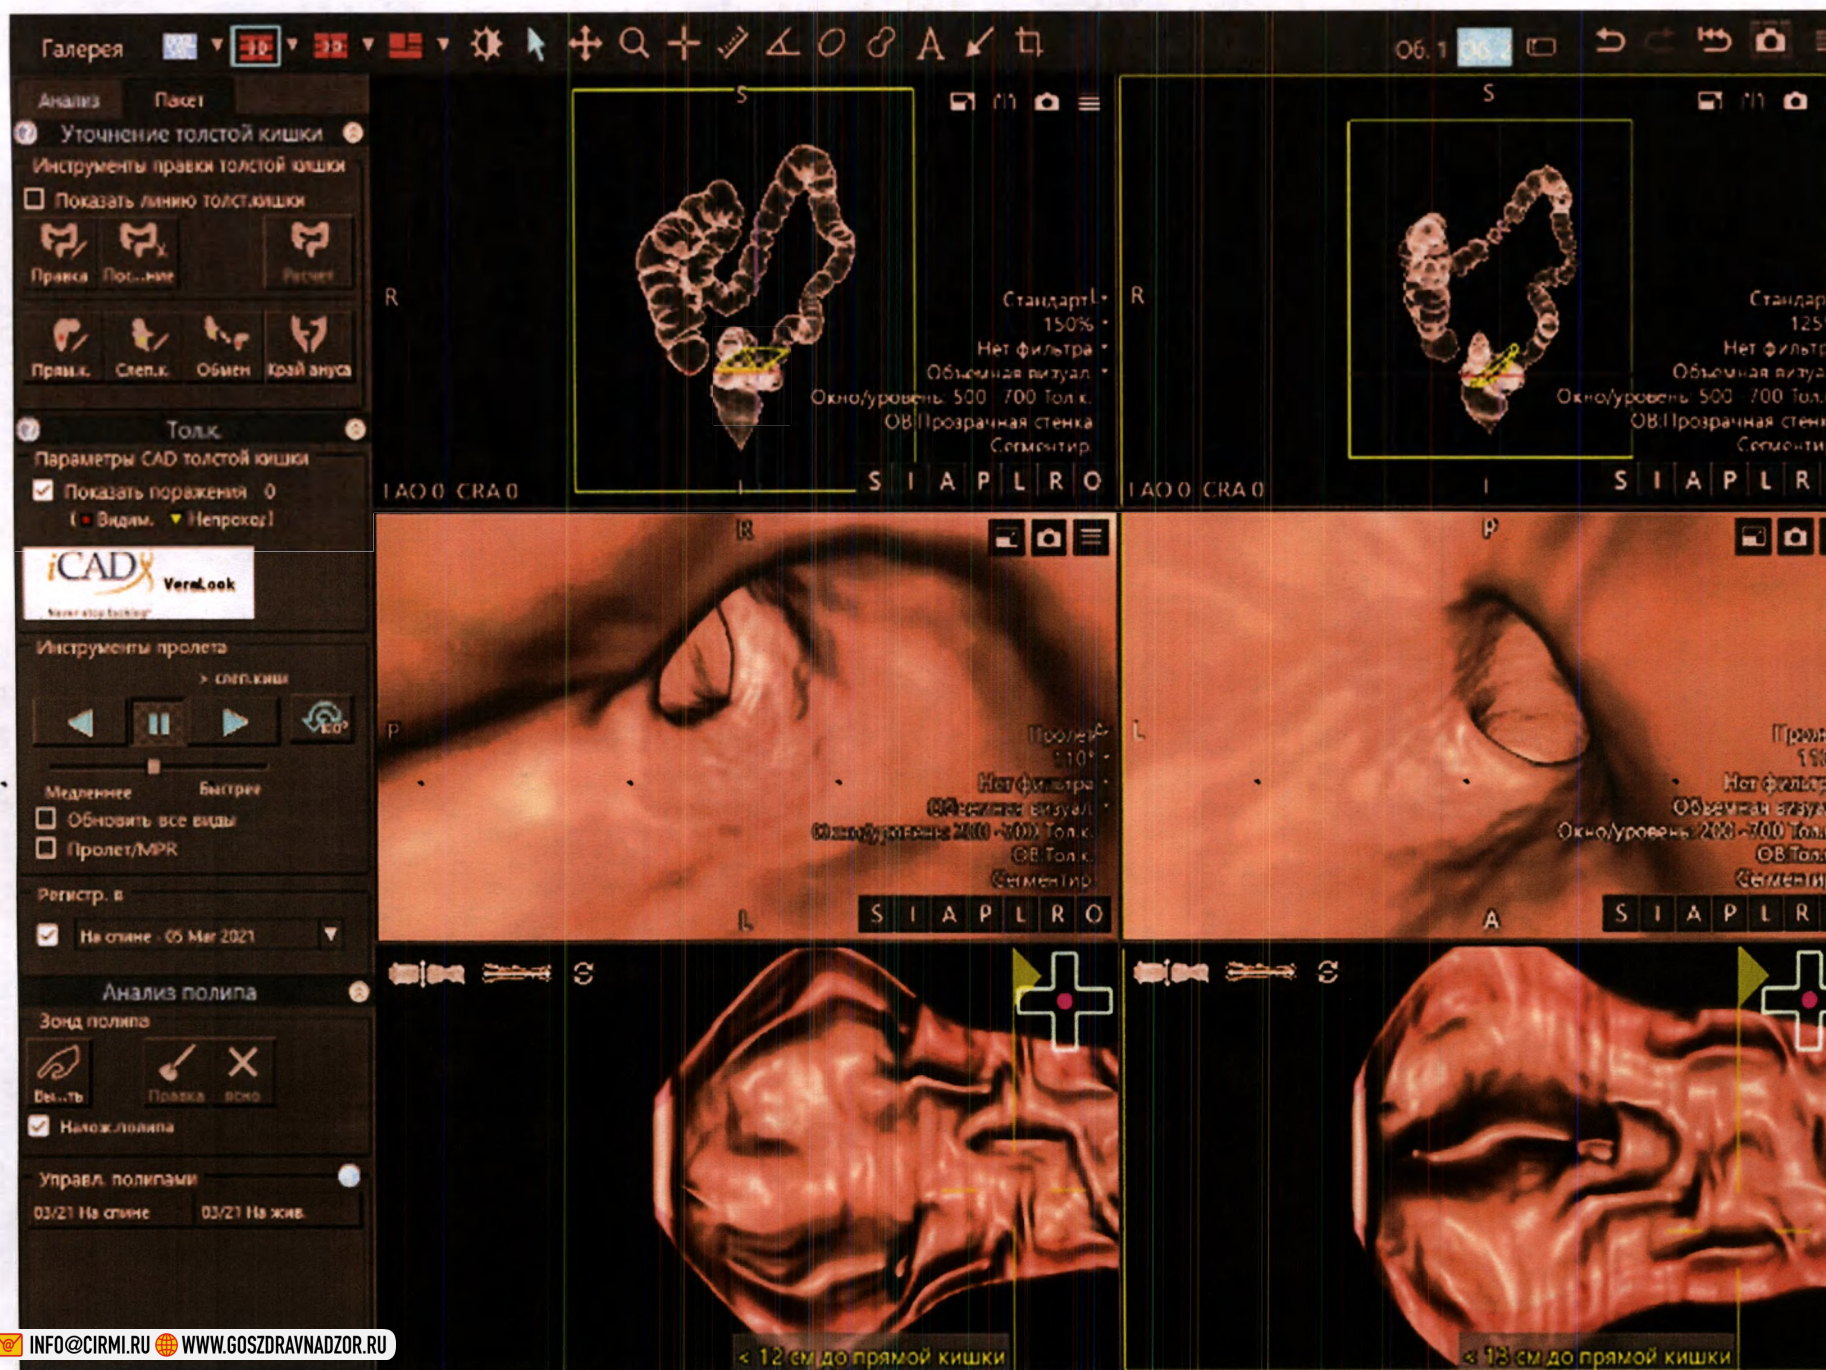


21. Программный пакет Vitrea CT Package №3 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)




21. Программный пакет Vitrea CT Package №3 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа плотности легочной ткани)

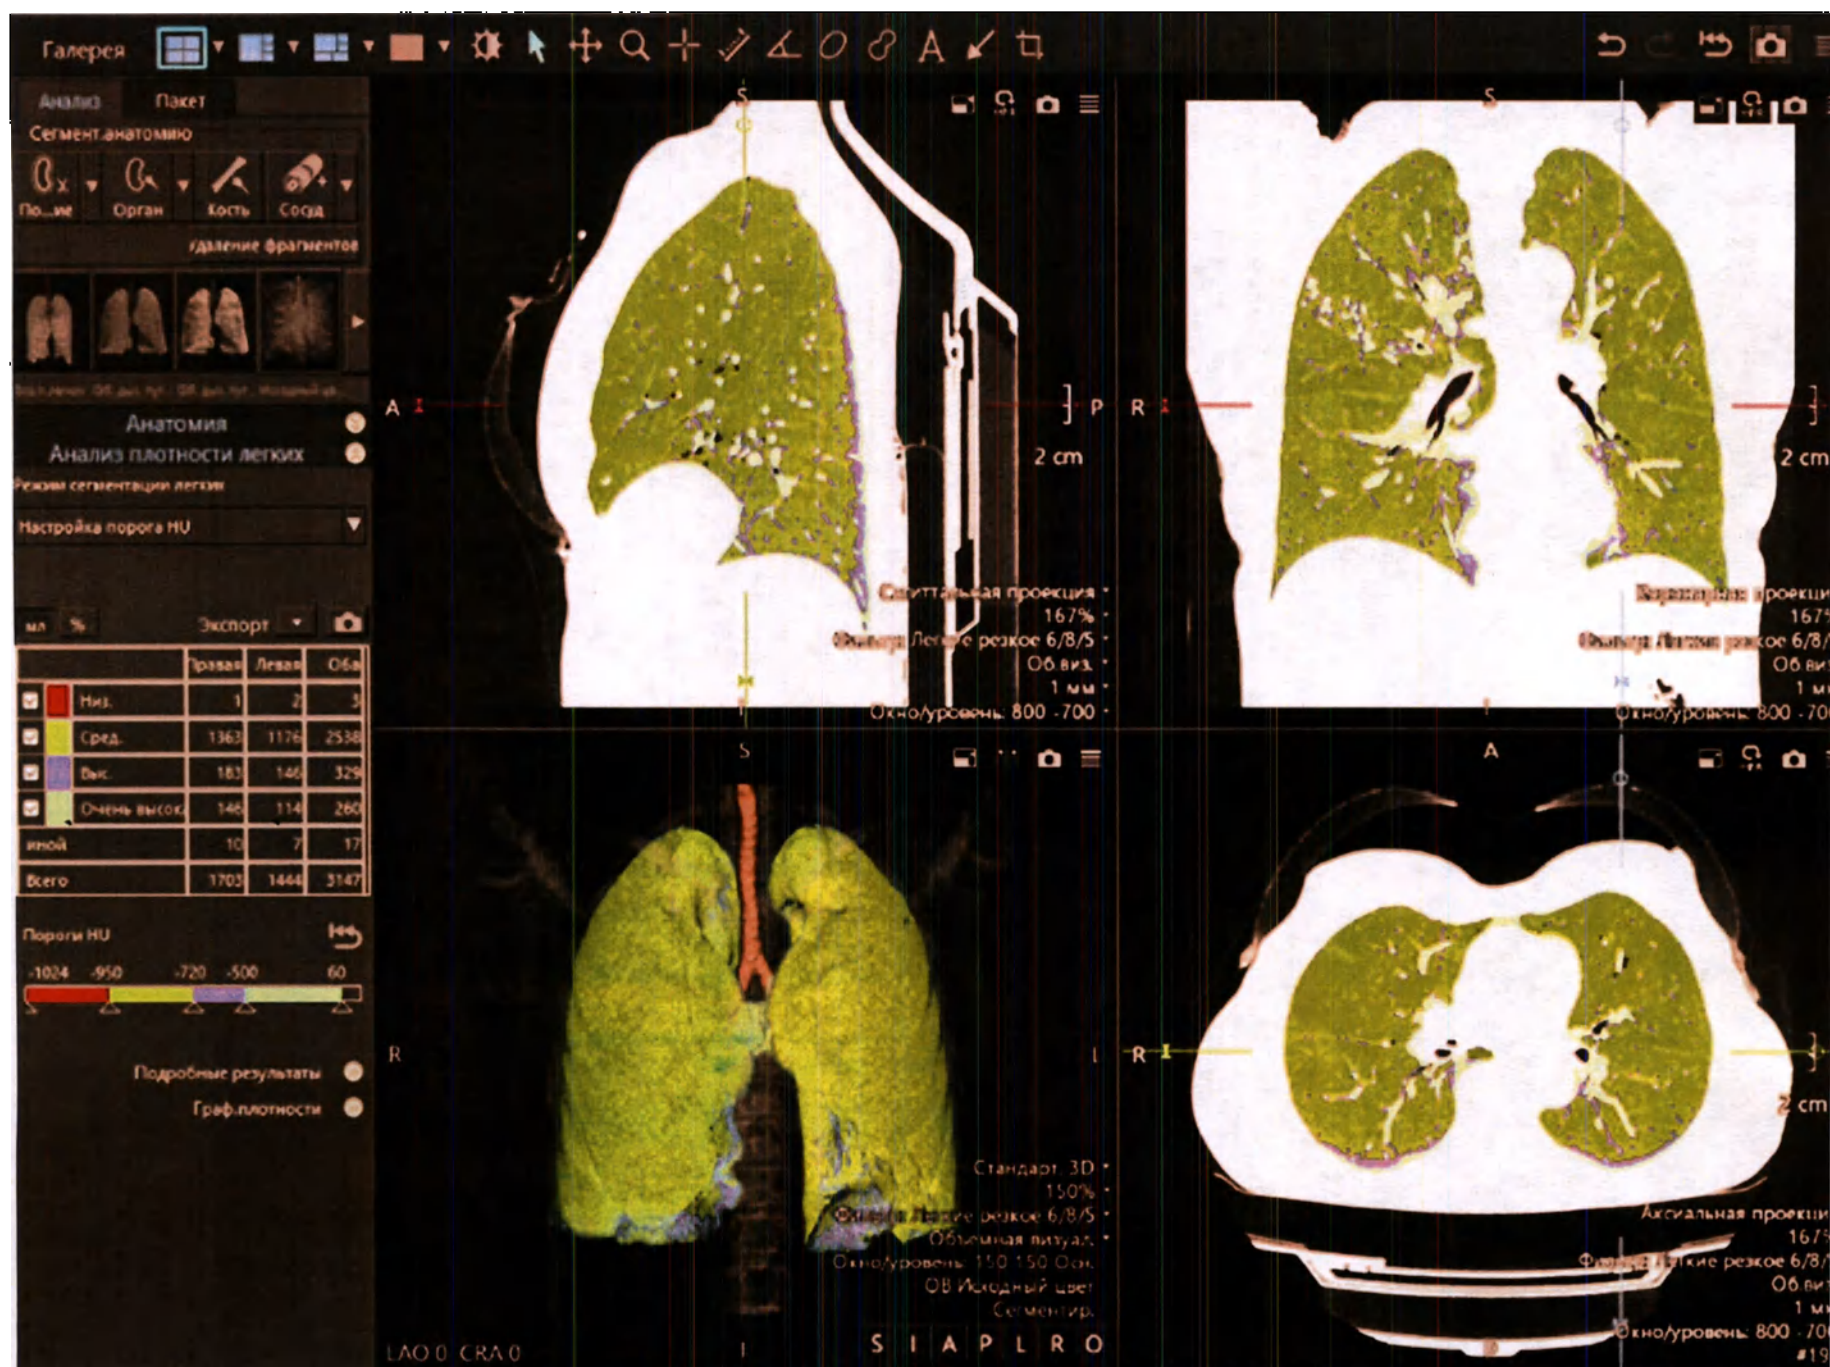


21. Программный пакет Vitrea CT Package №3 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

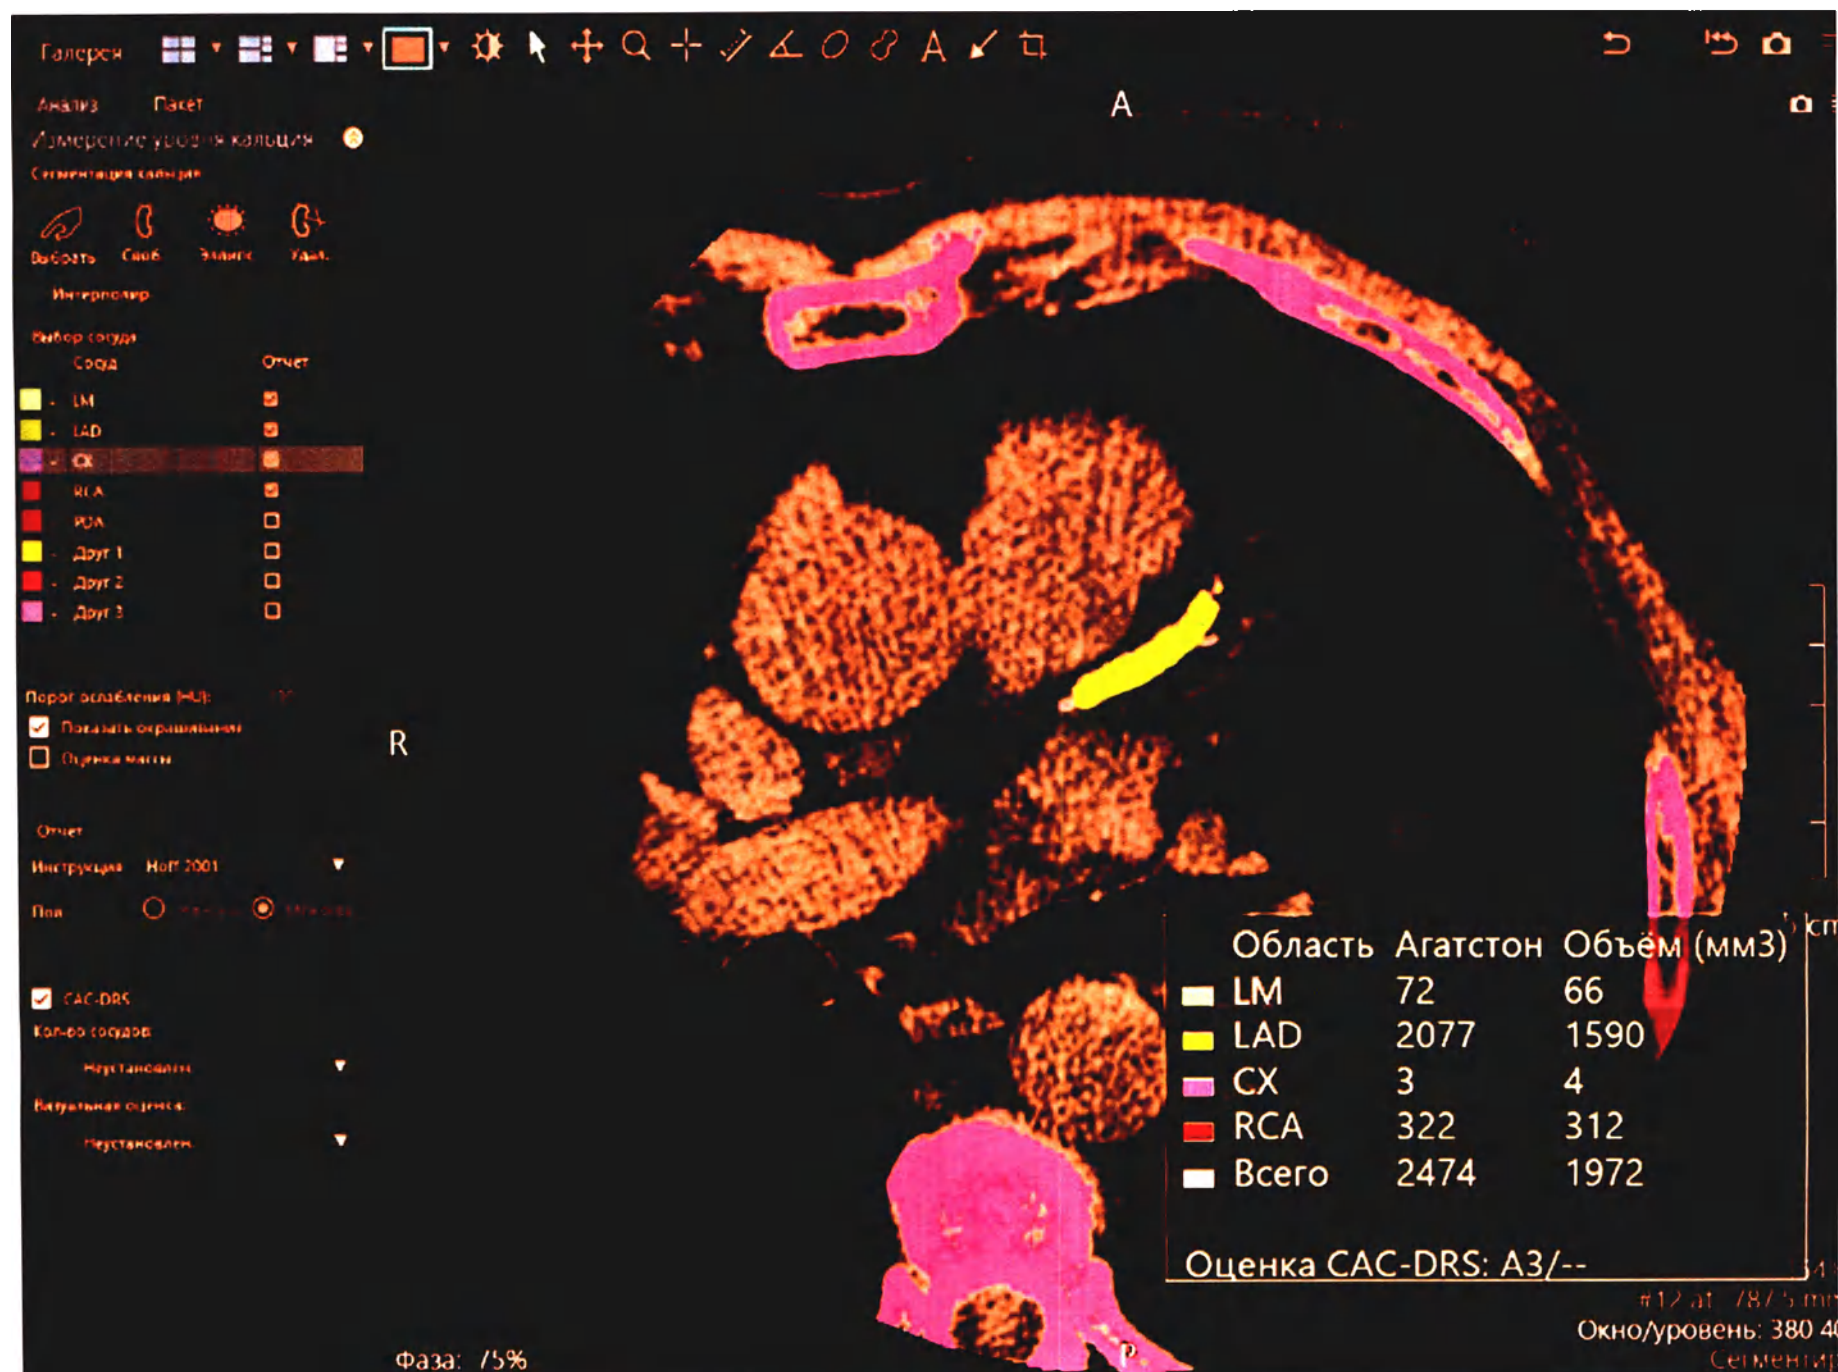


21. Программный пакет Vitrea CT Package №3 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для улучшения качества изображений)

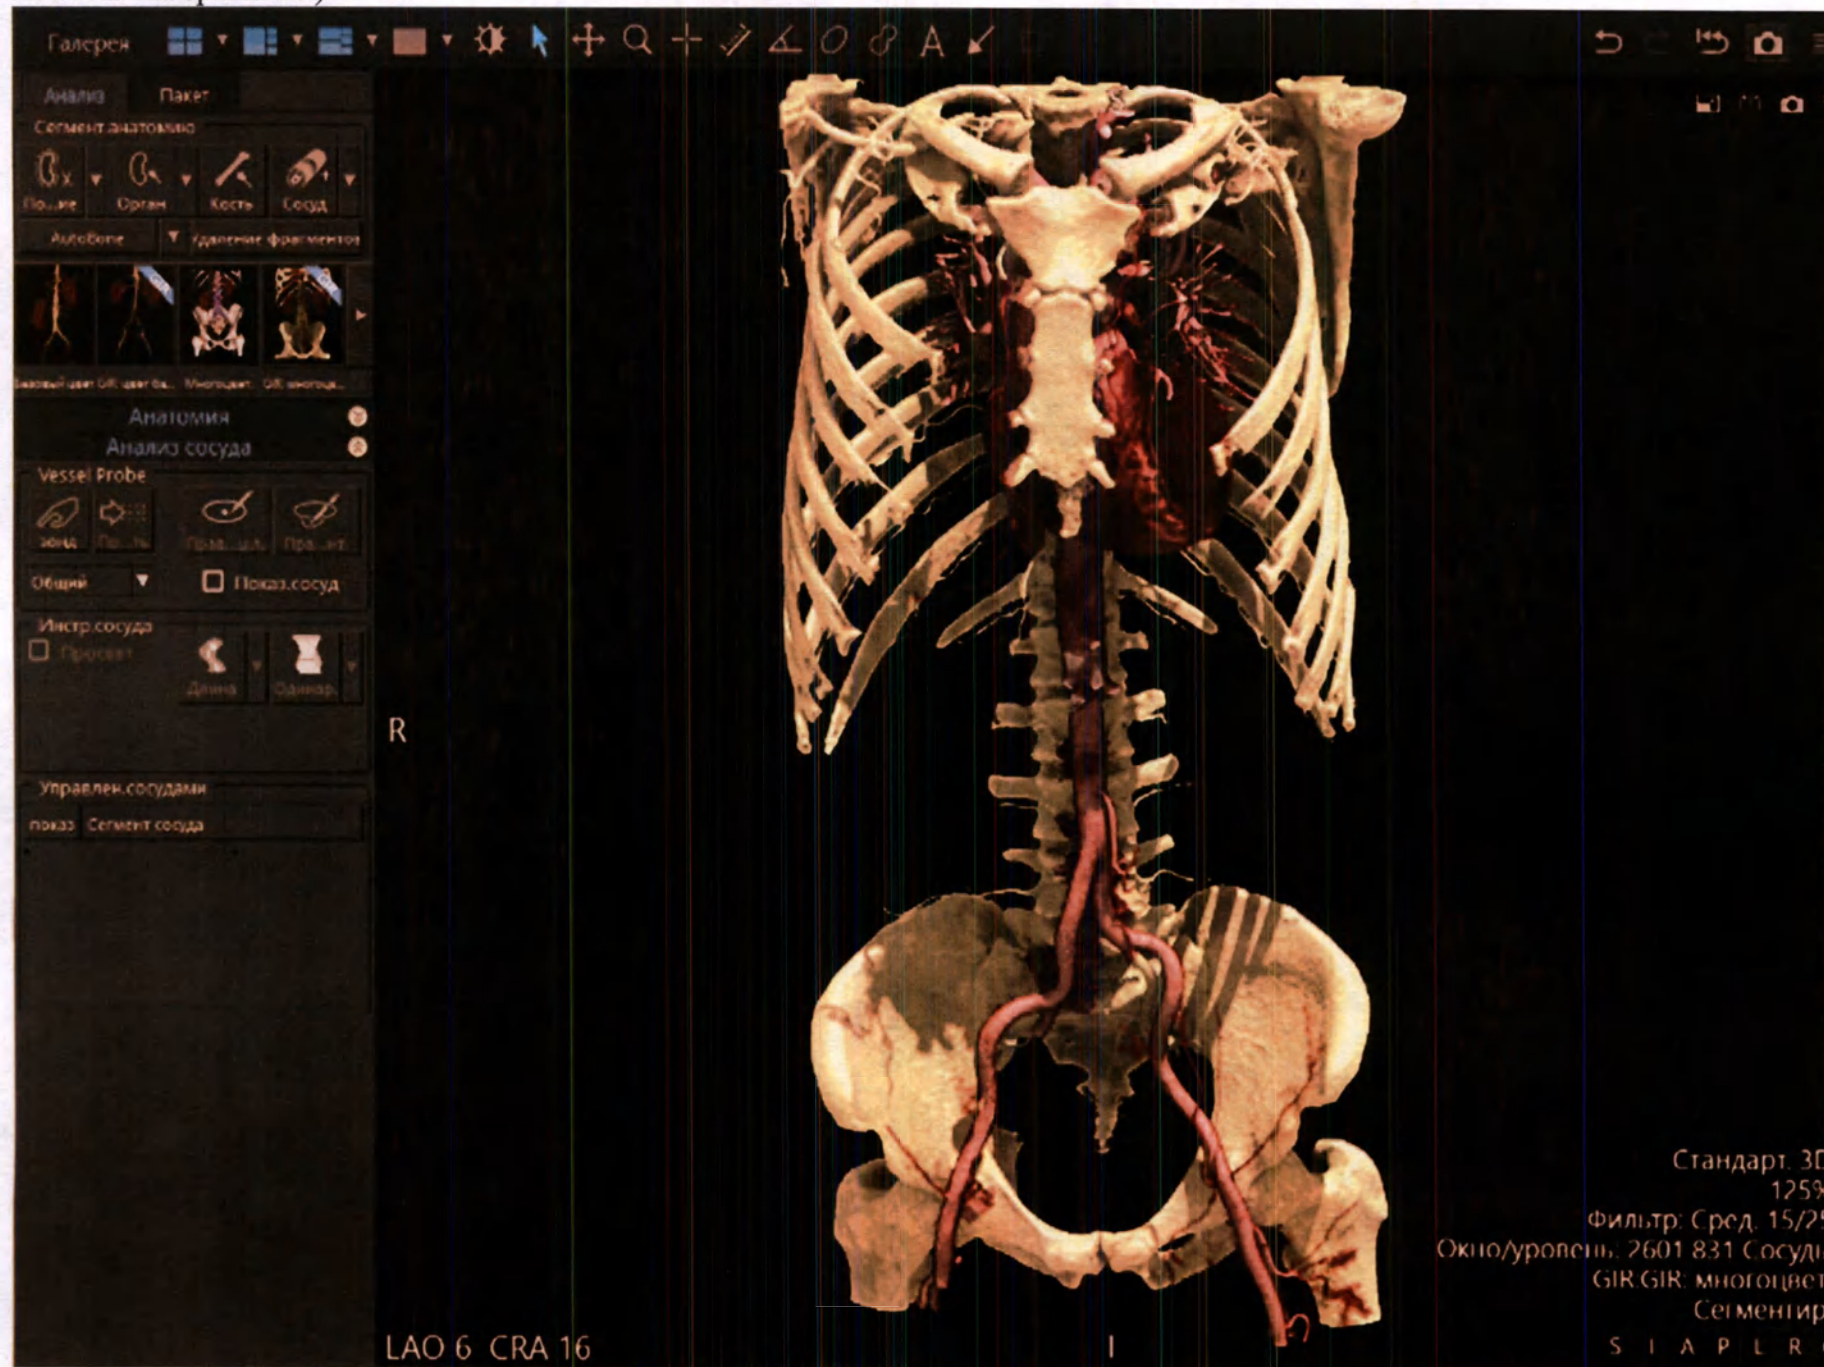


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для планирования установки стента)

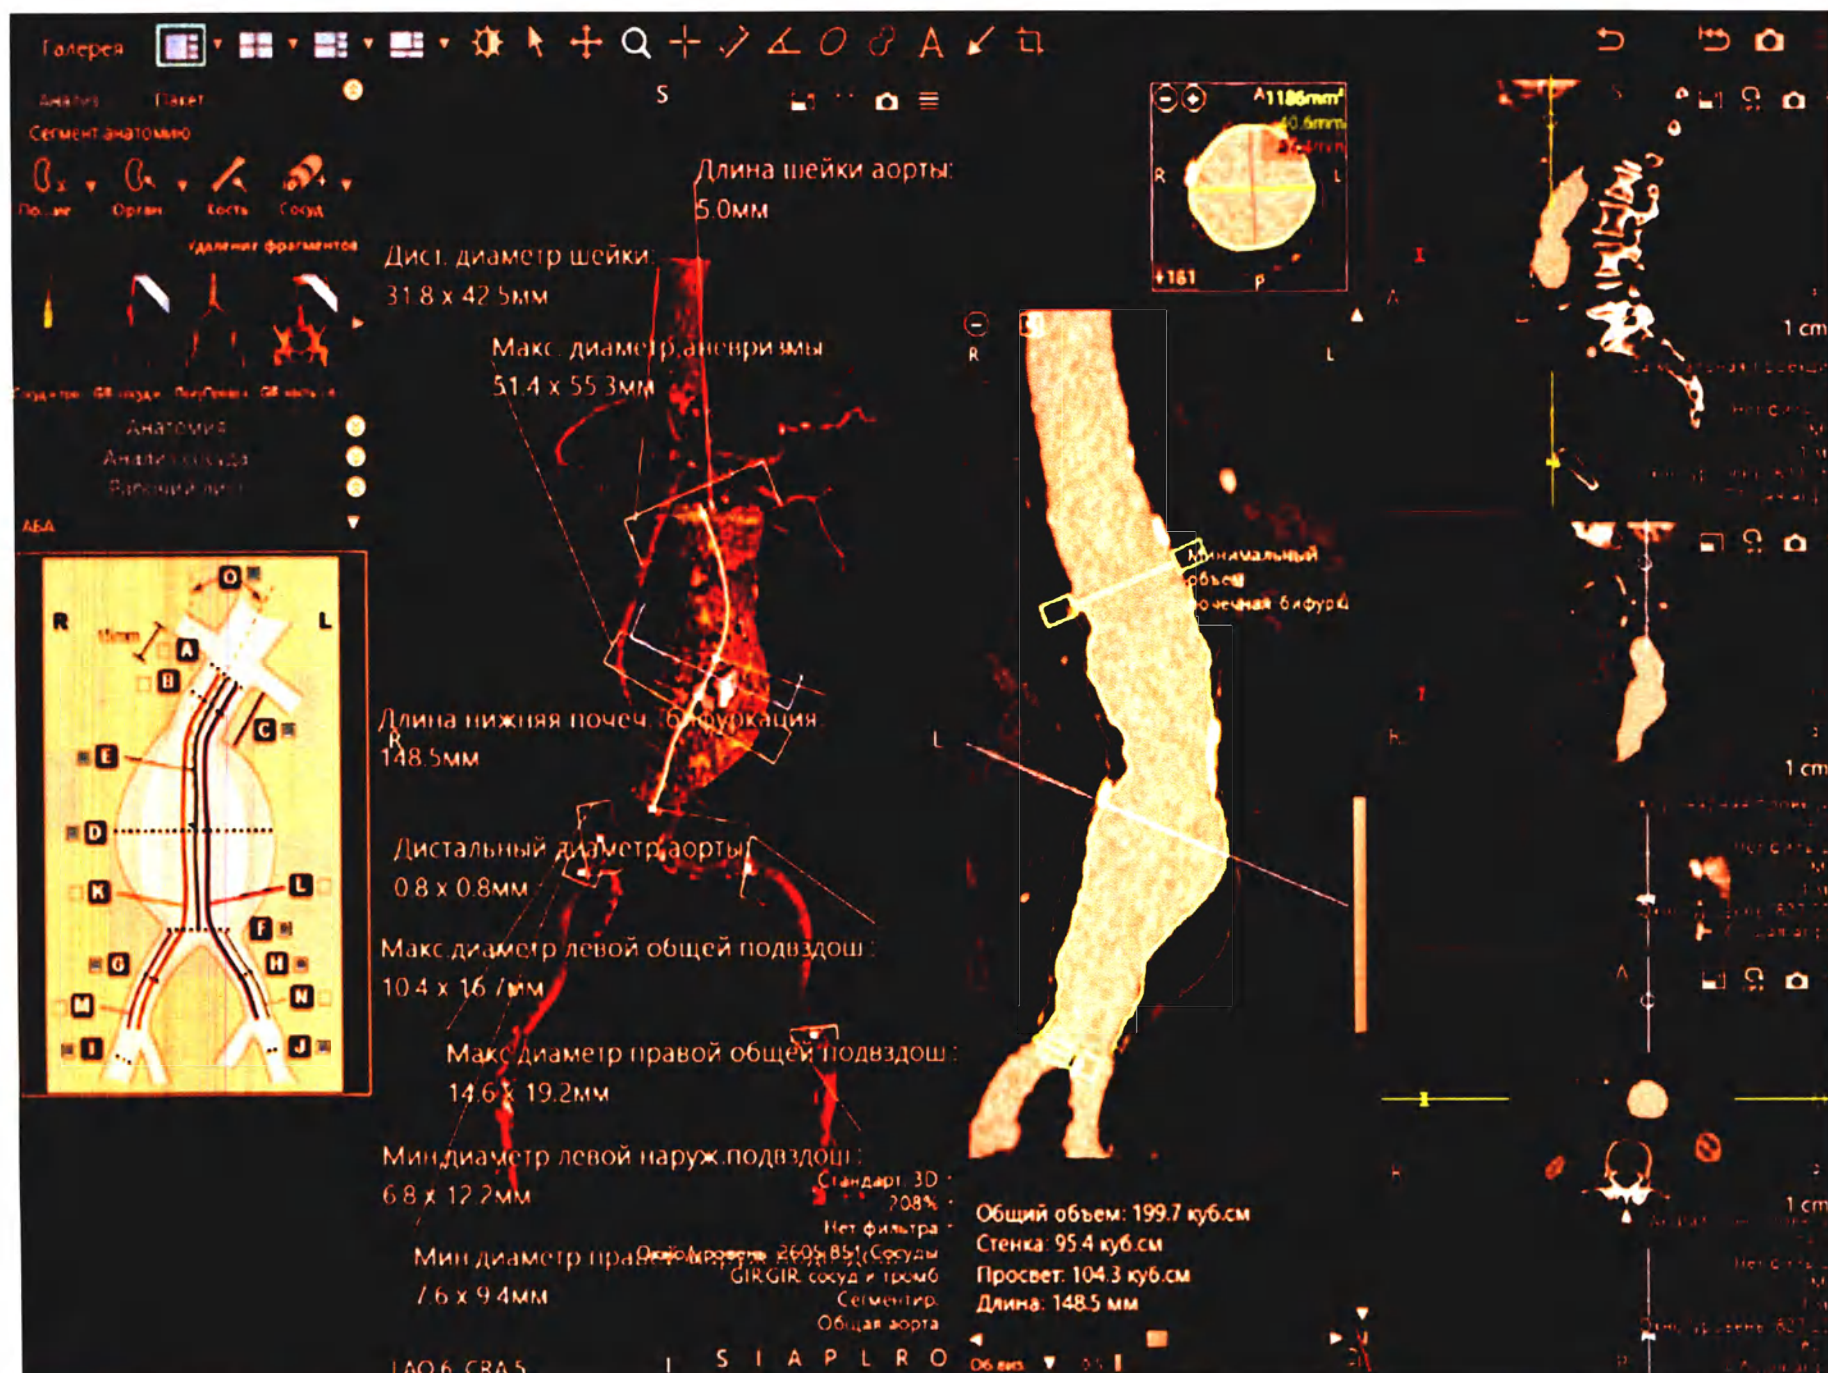


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

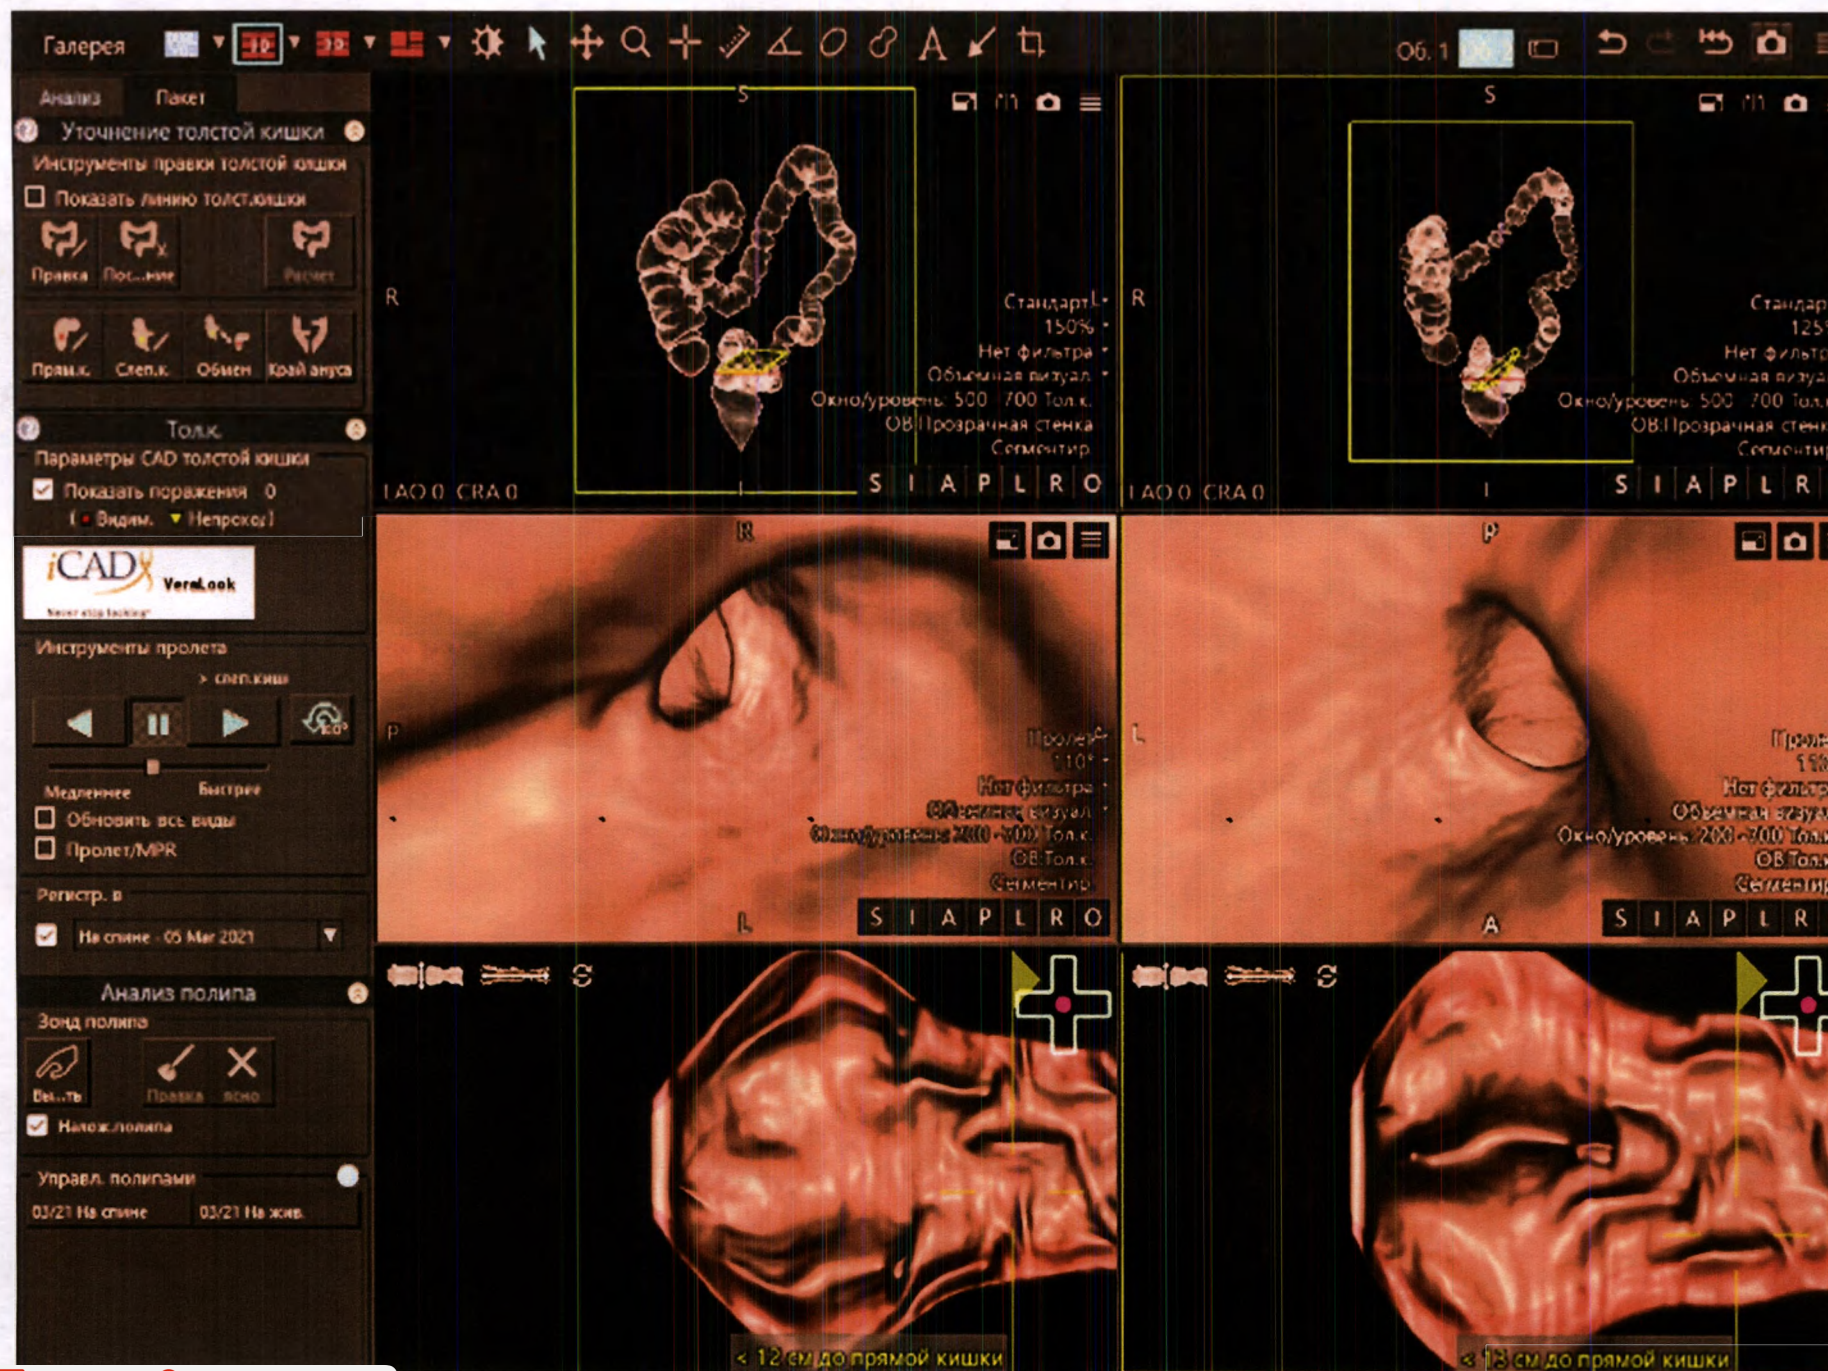


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)

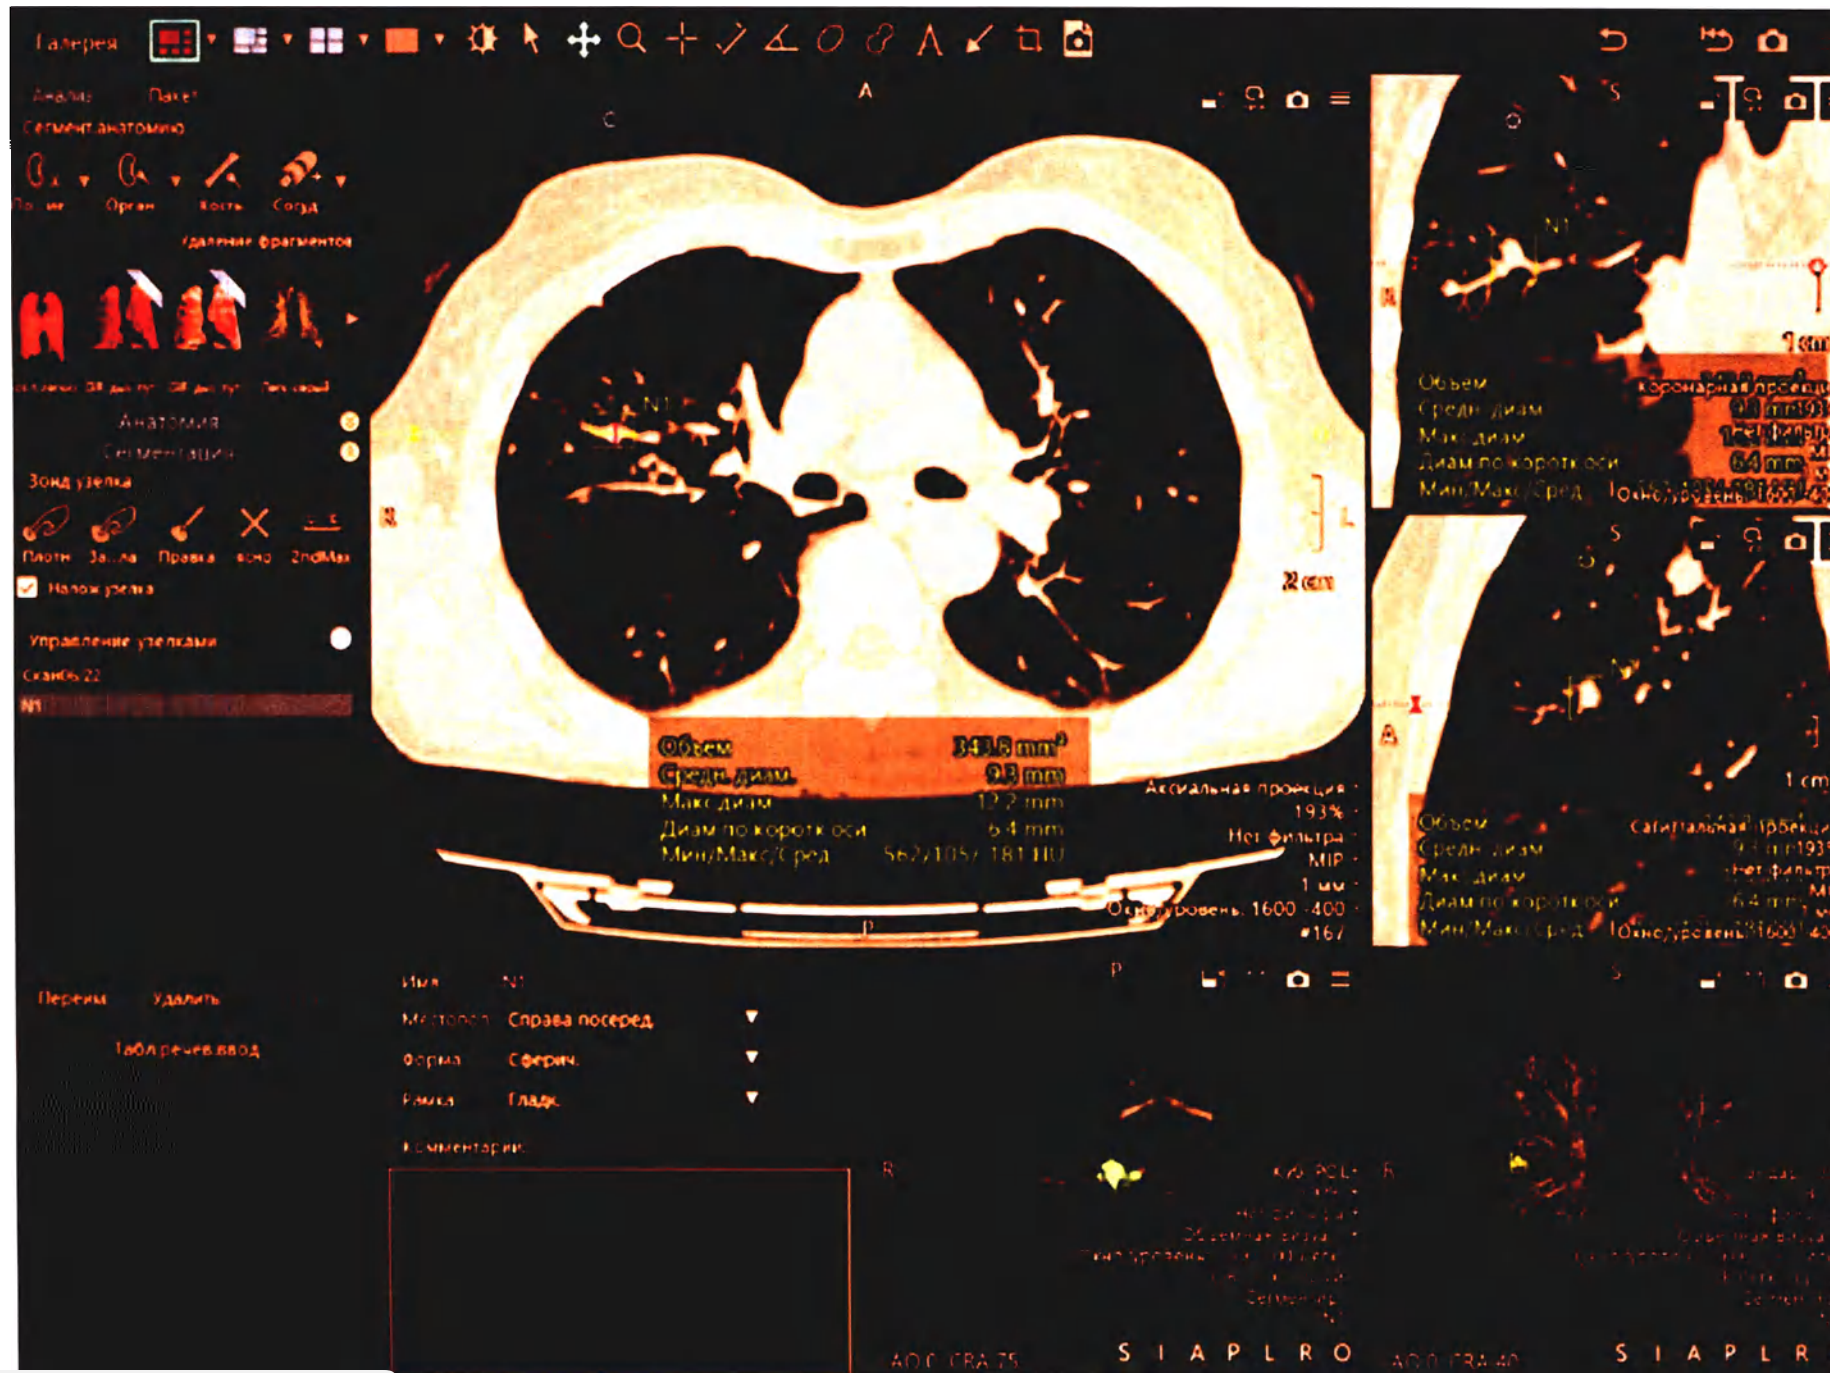


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа плотности легочной ткани)

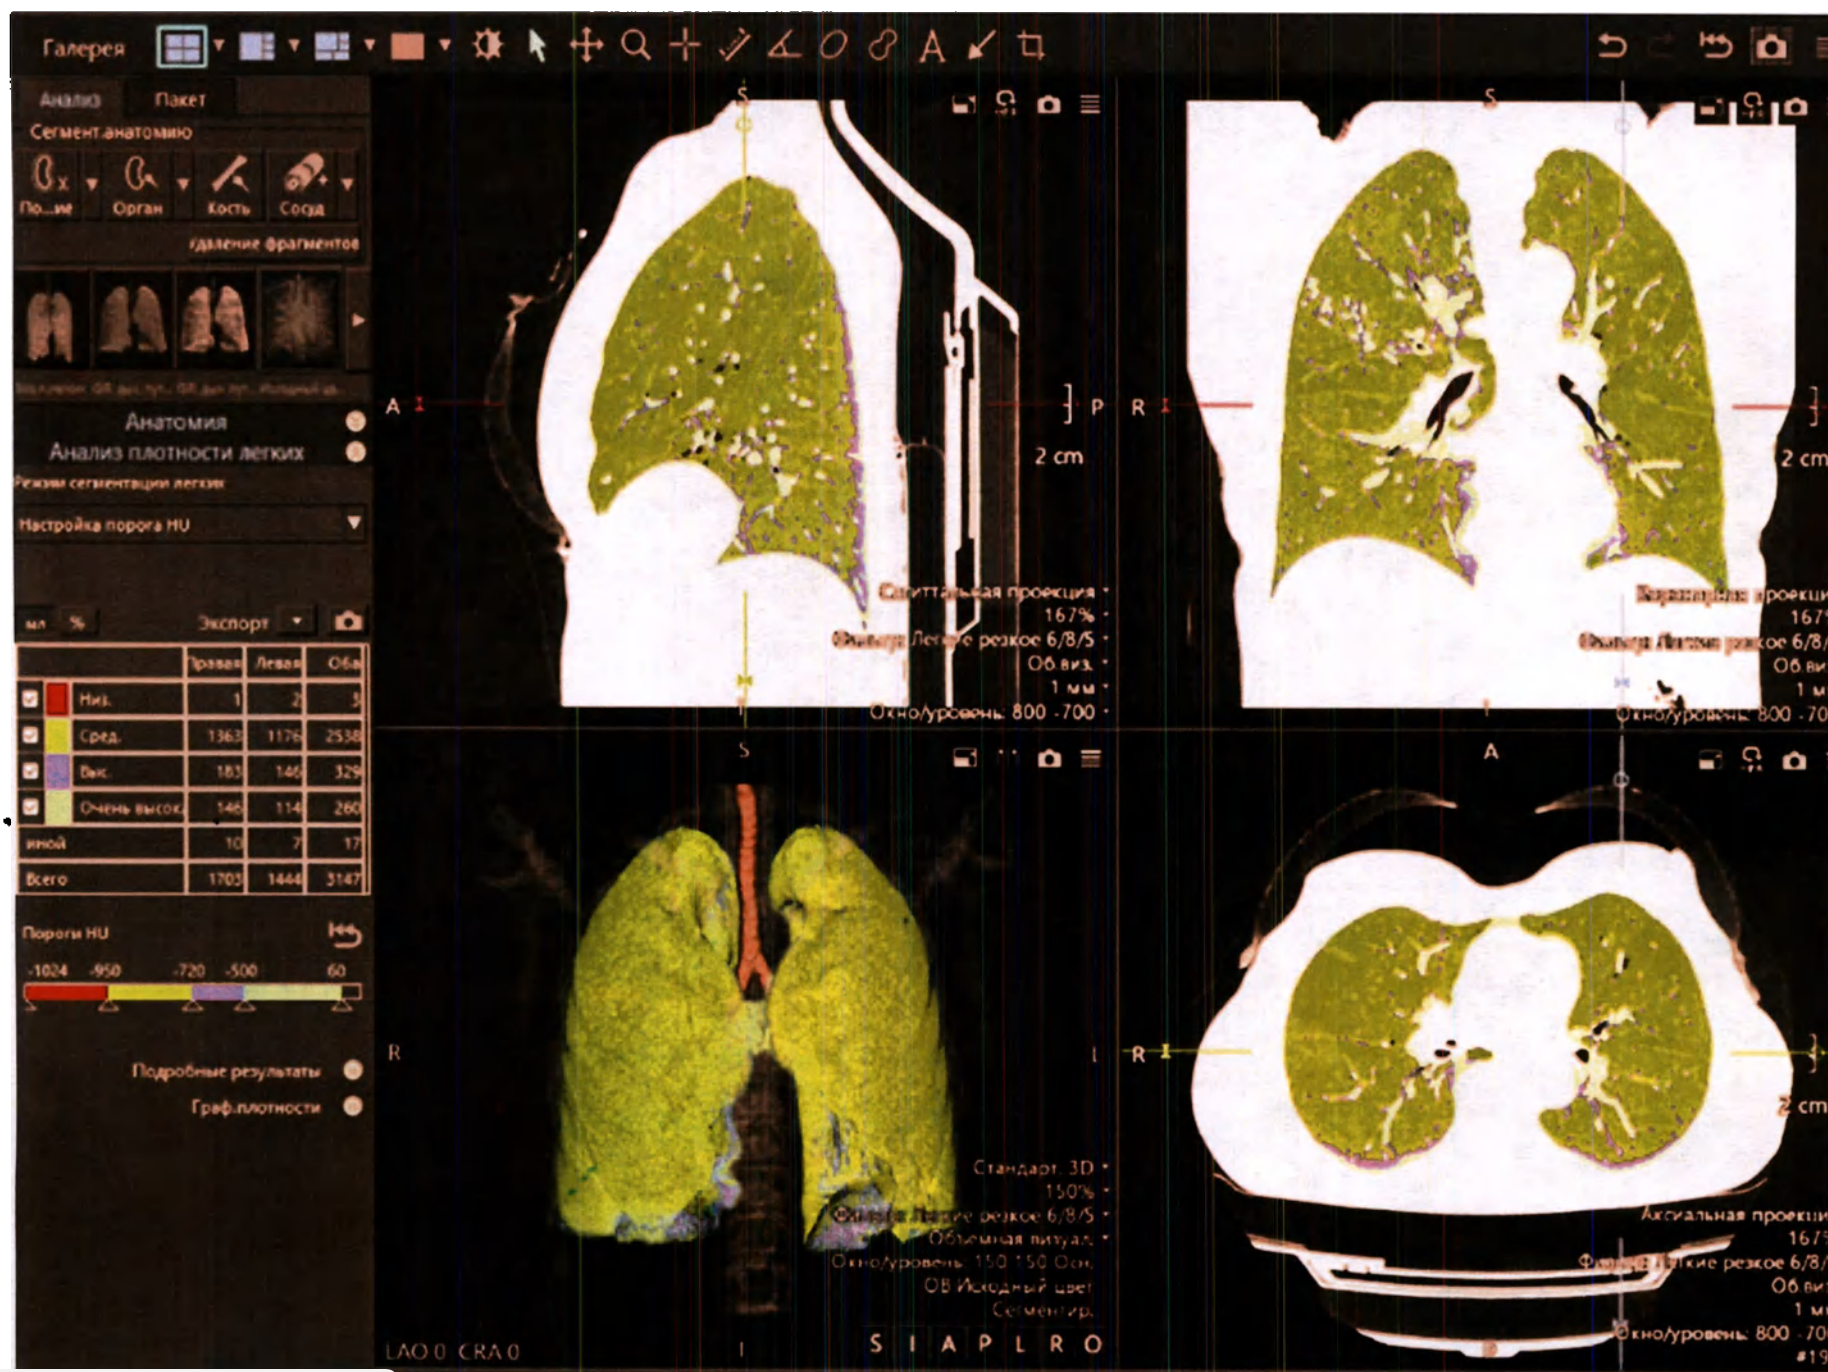


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа перфузии головного мозга)

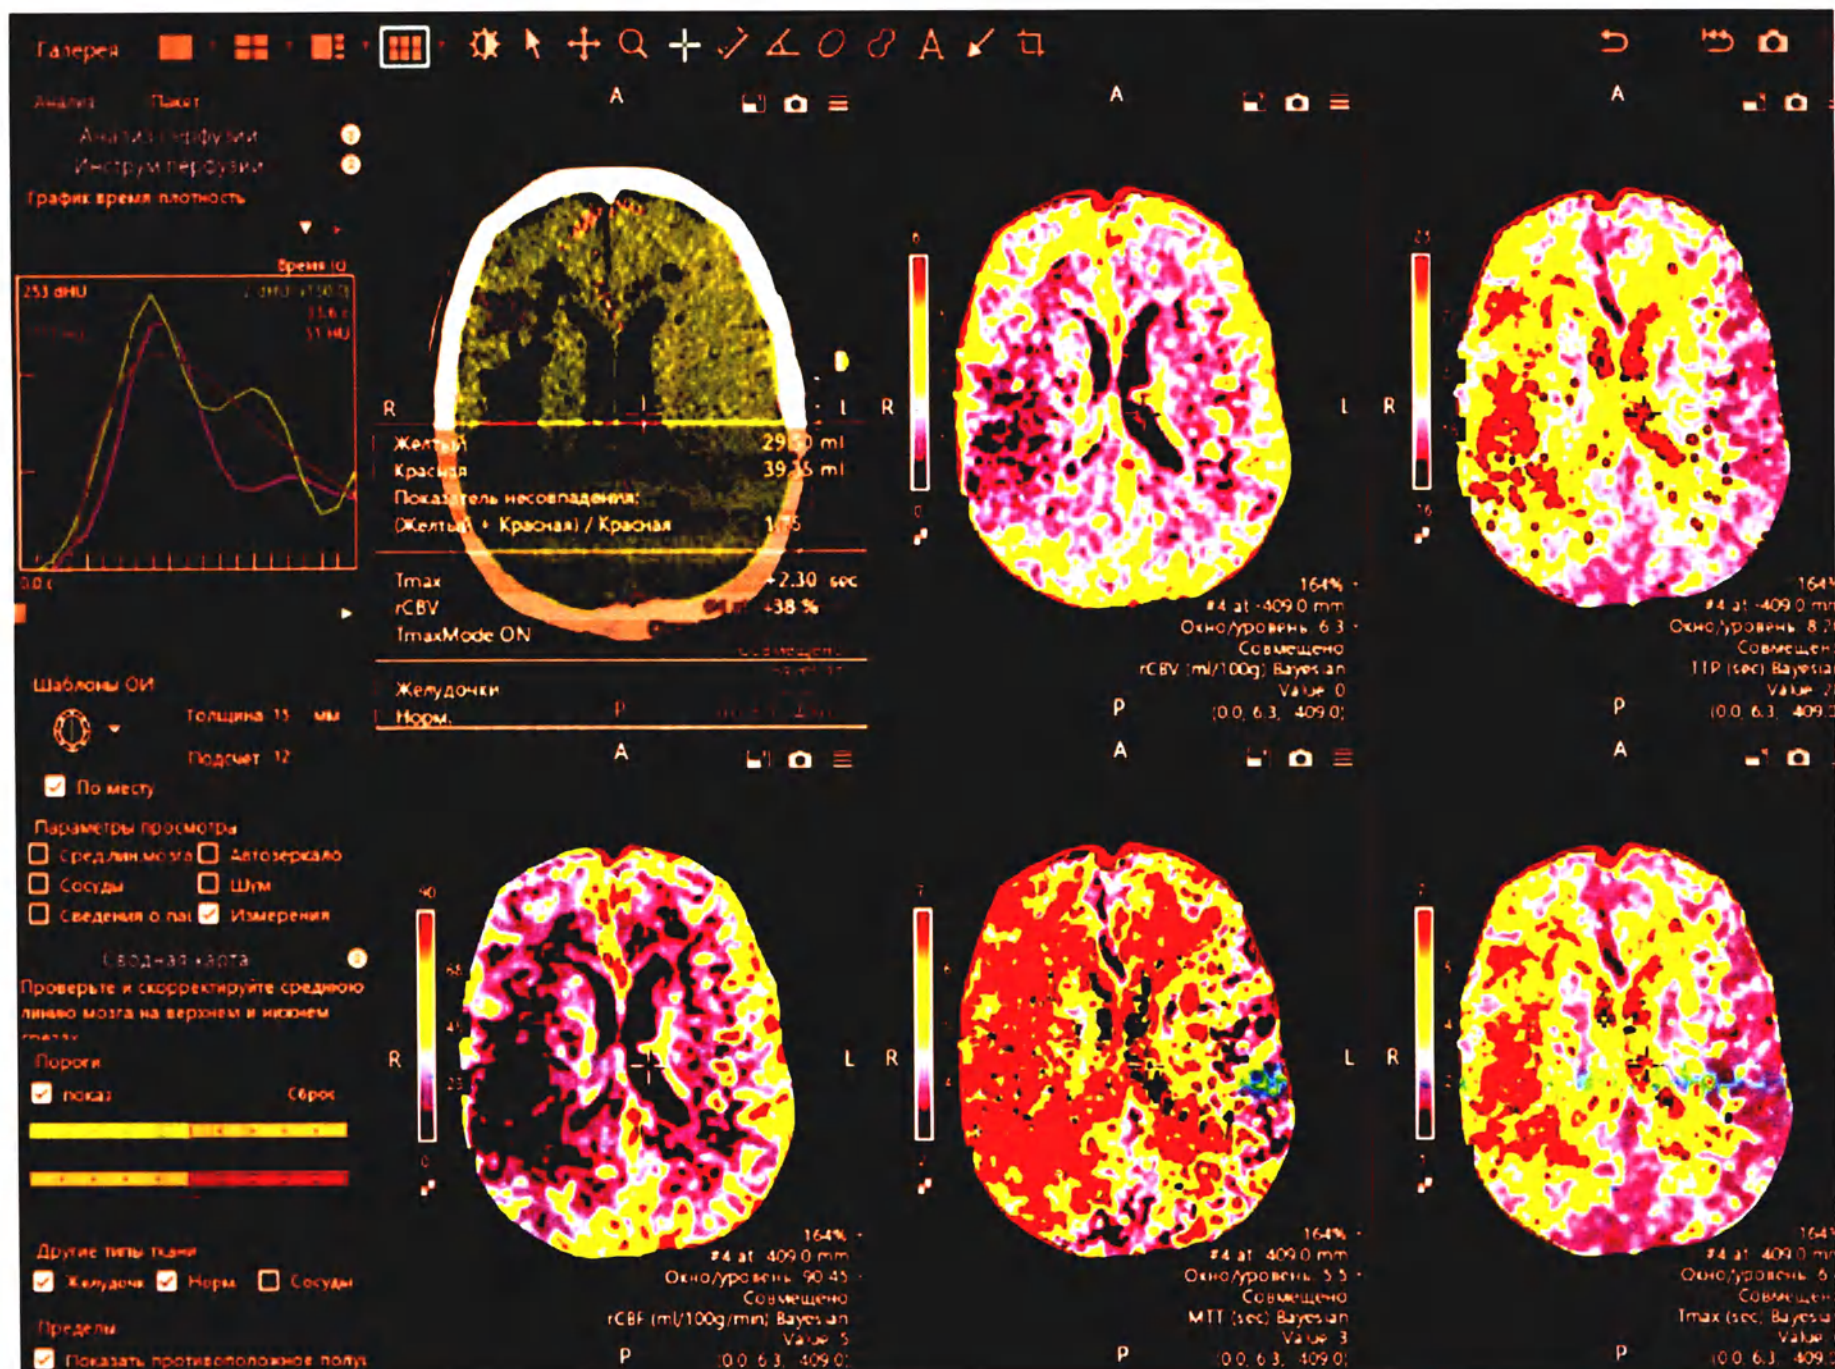


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

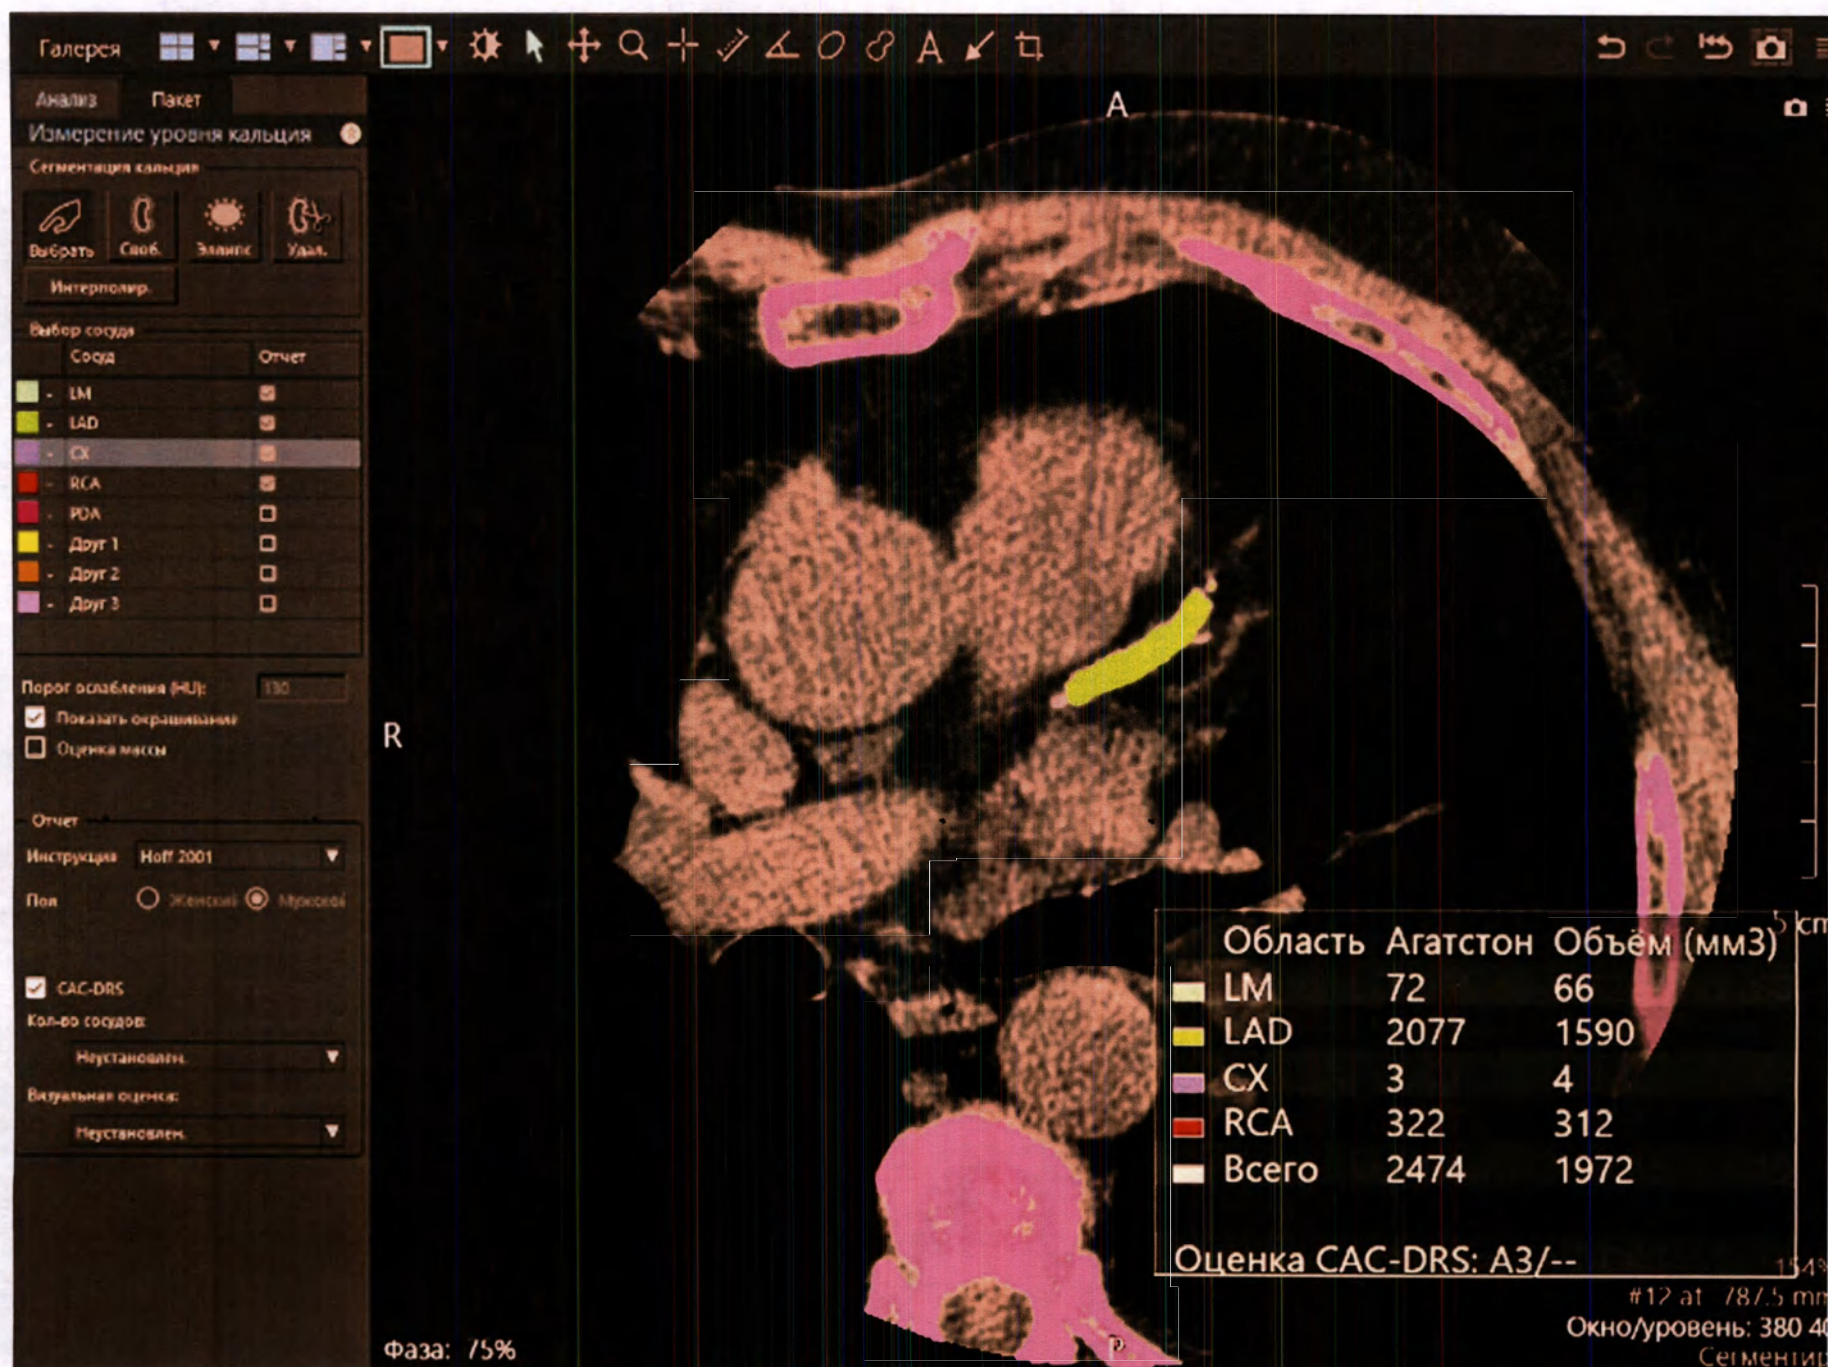


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов)

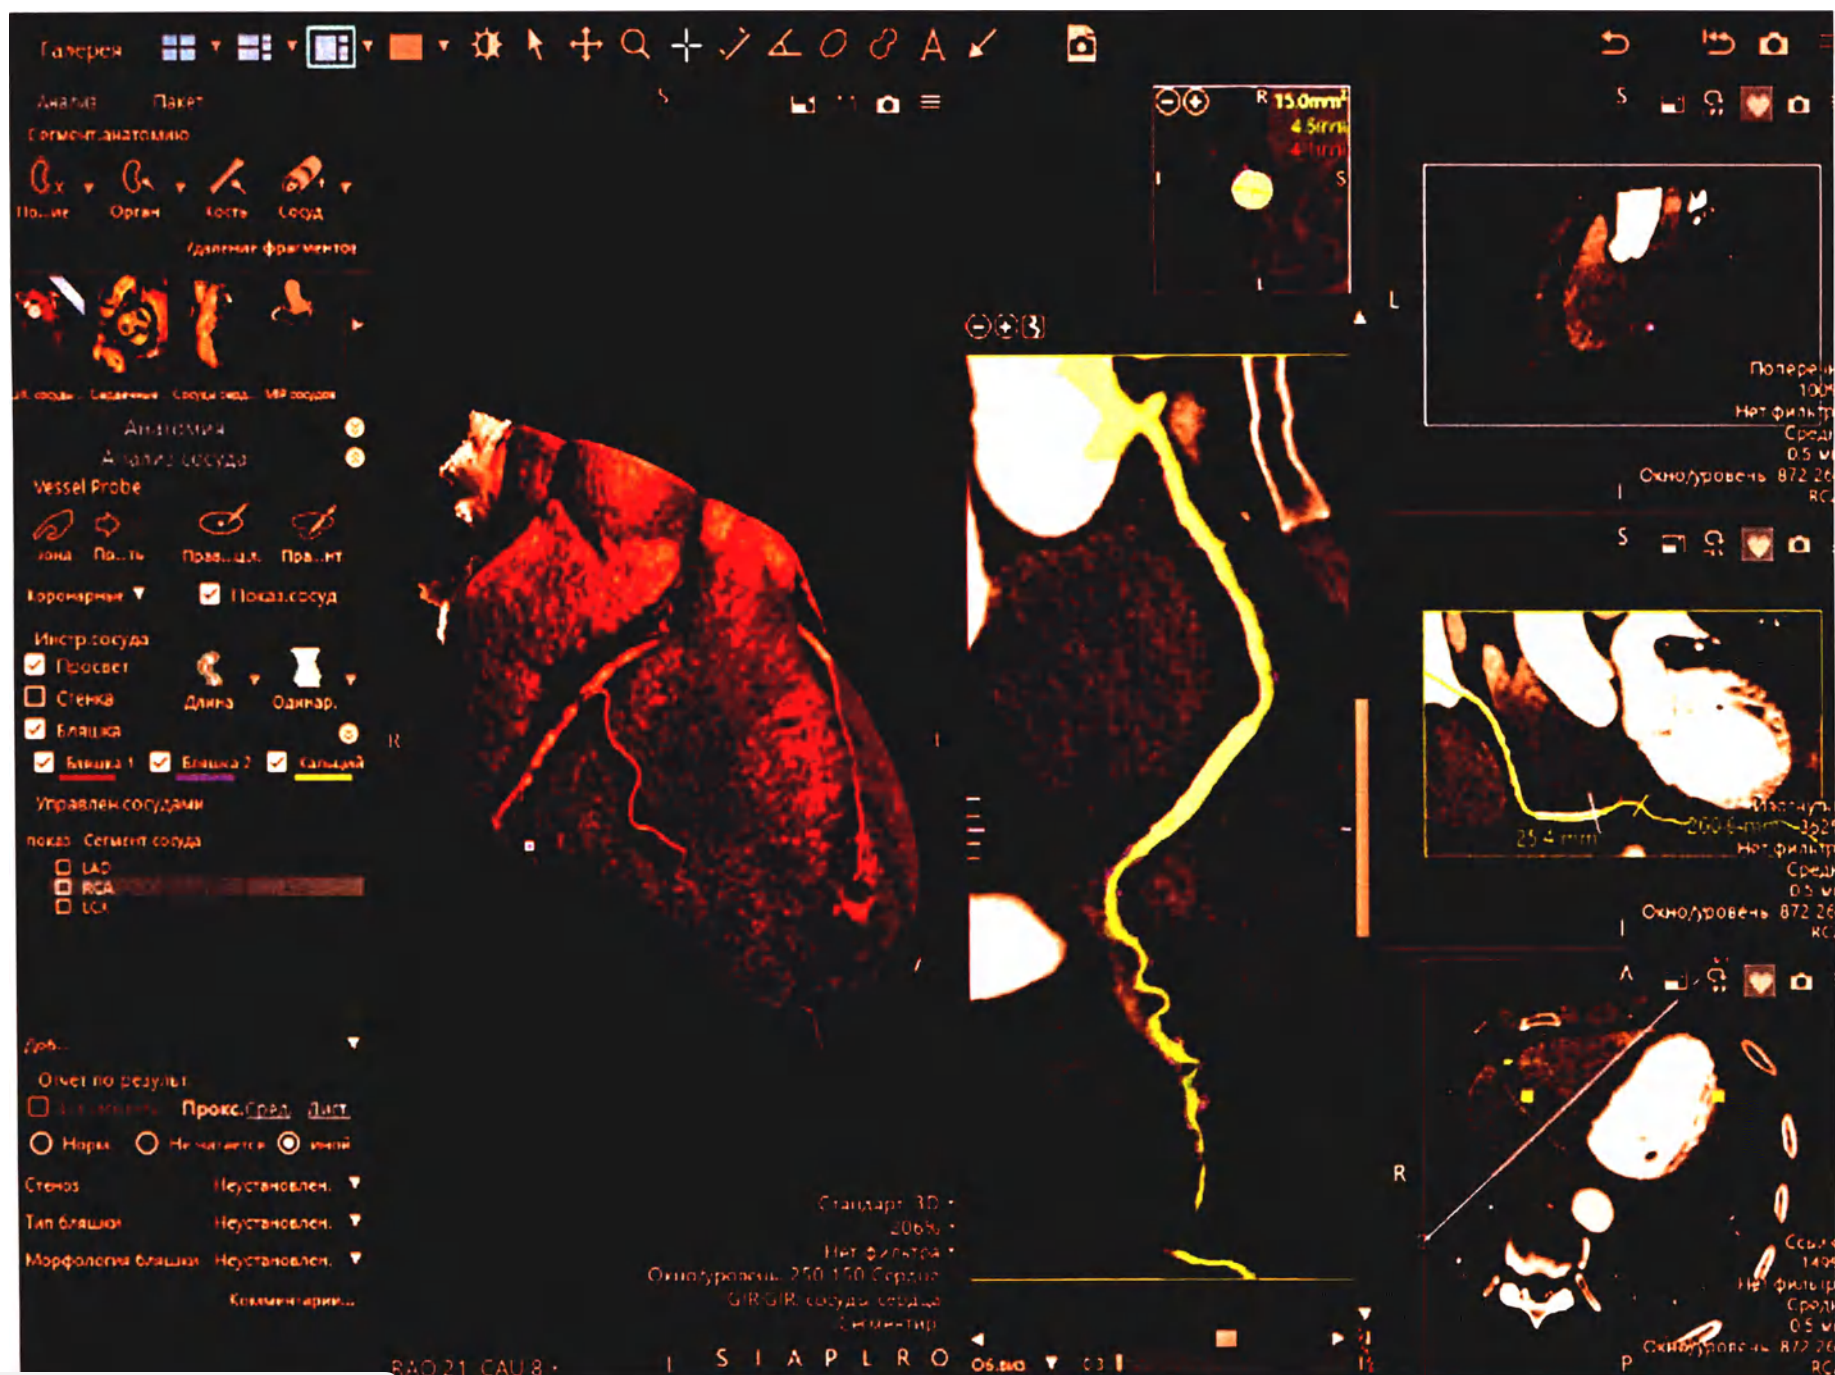


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

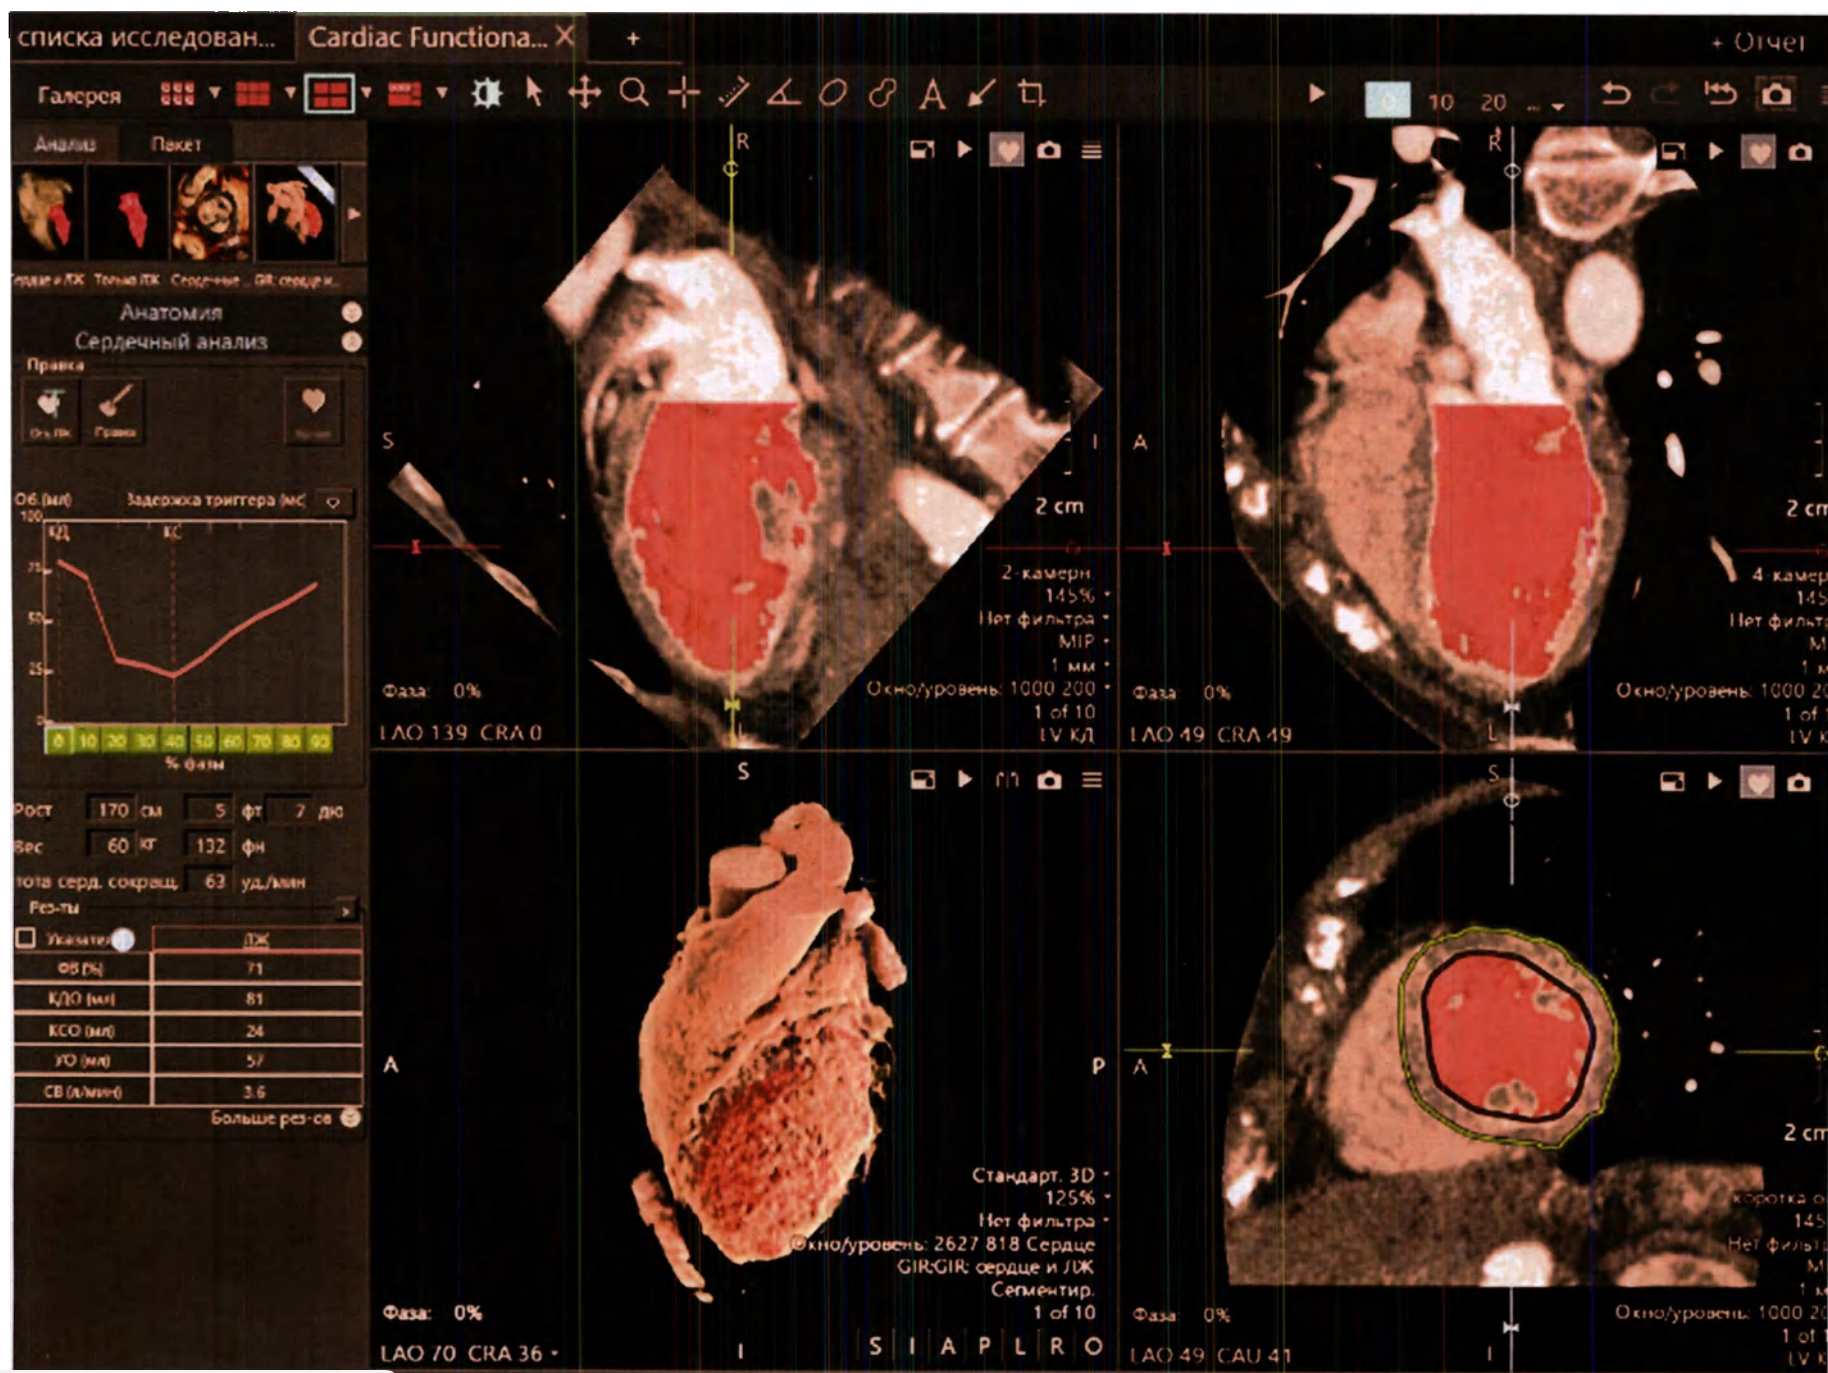


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек)

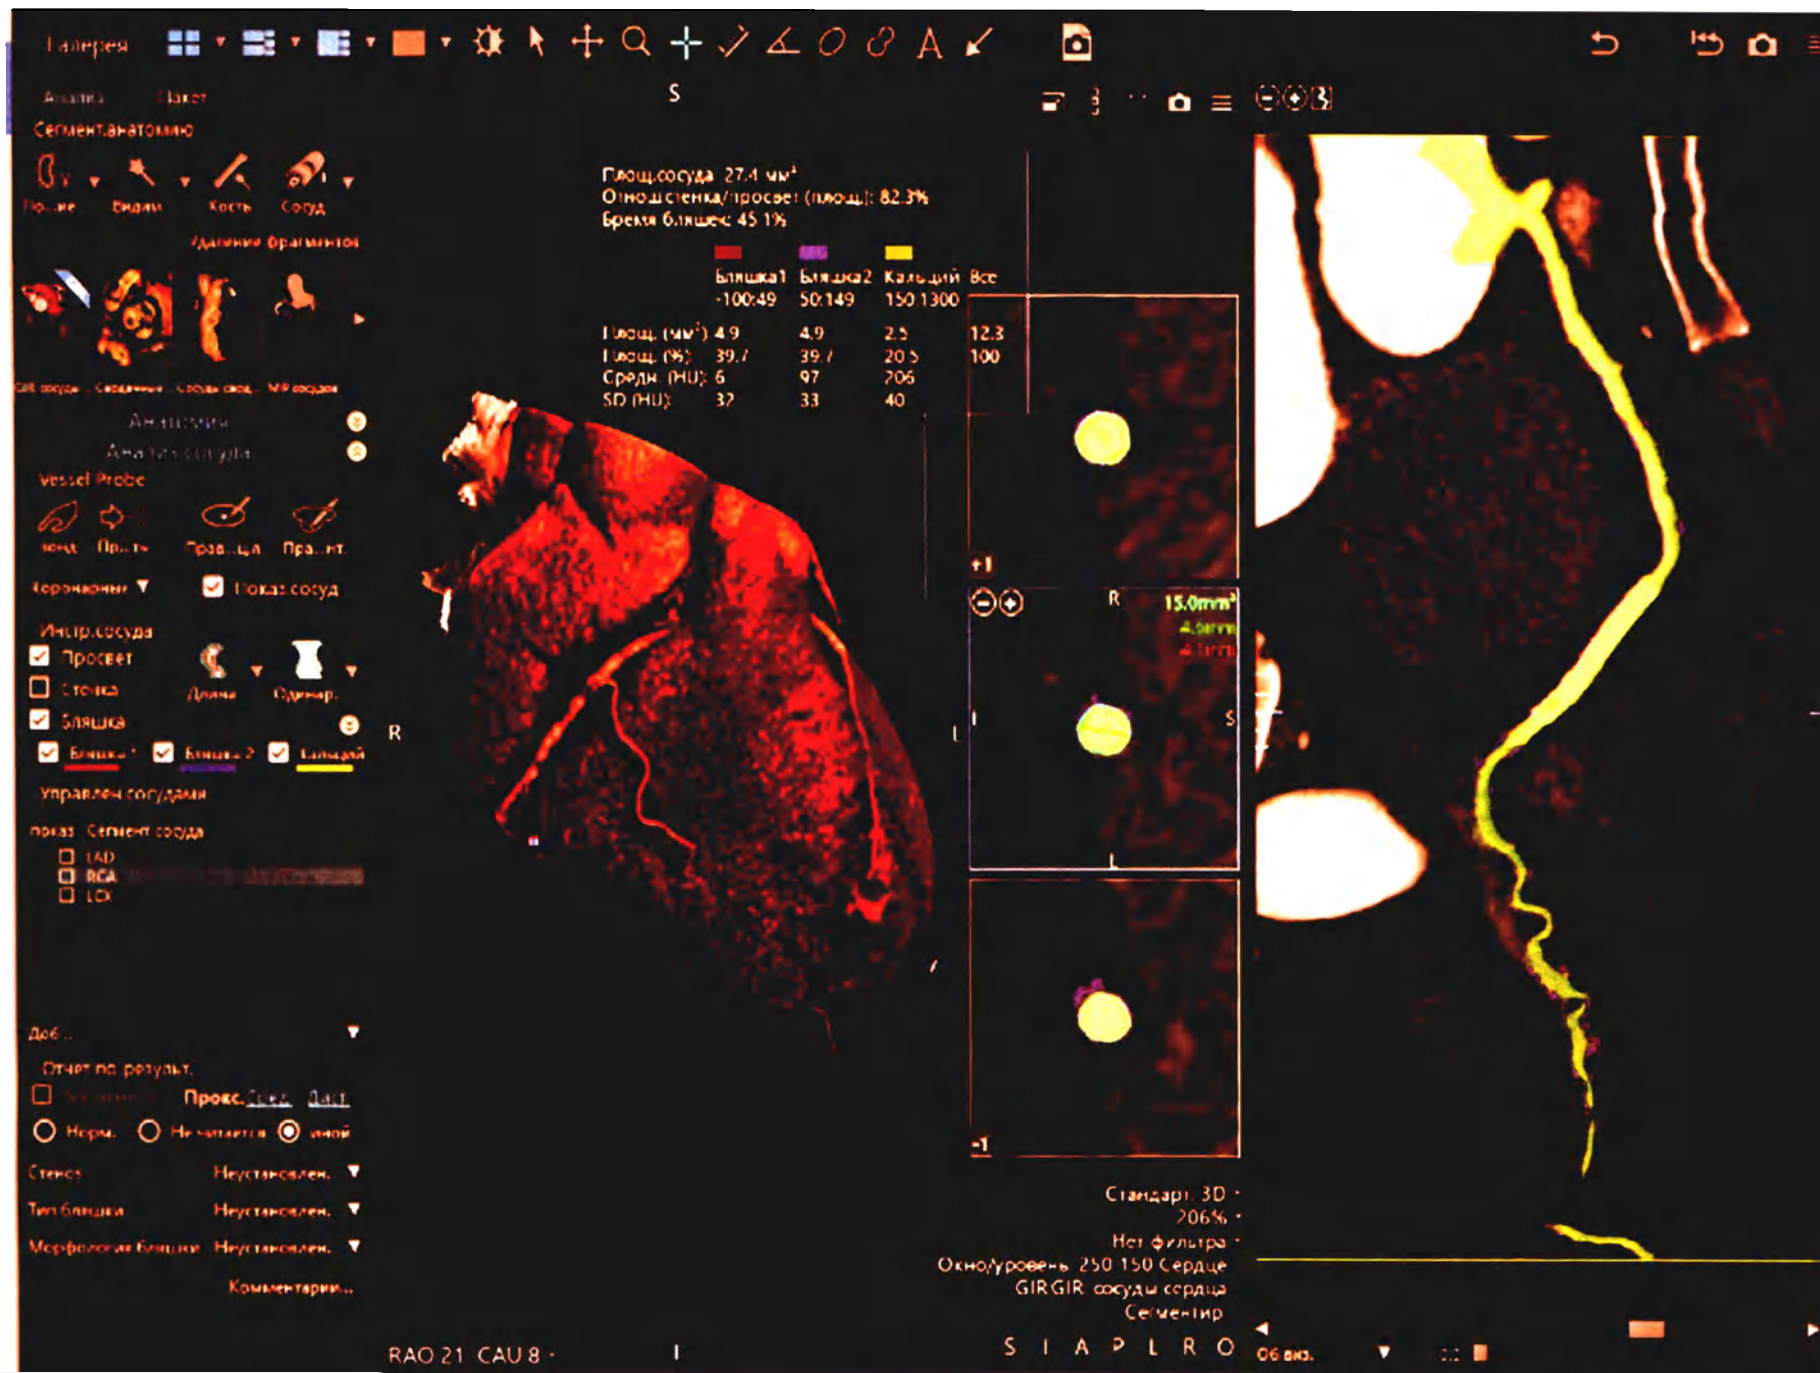

22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа объемных данных перфузии головного мозга)

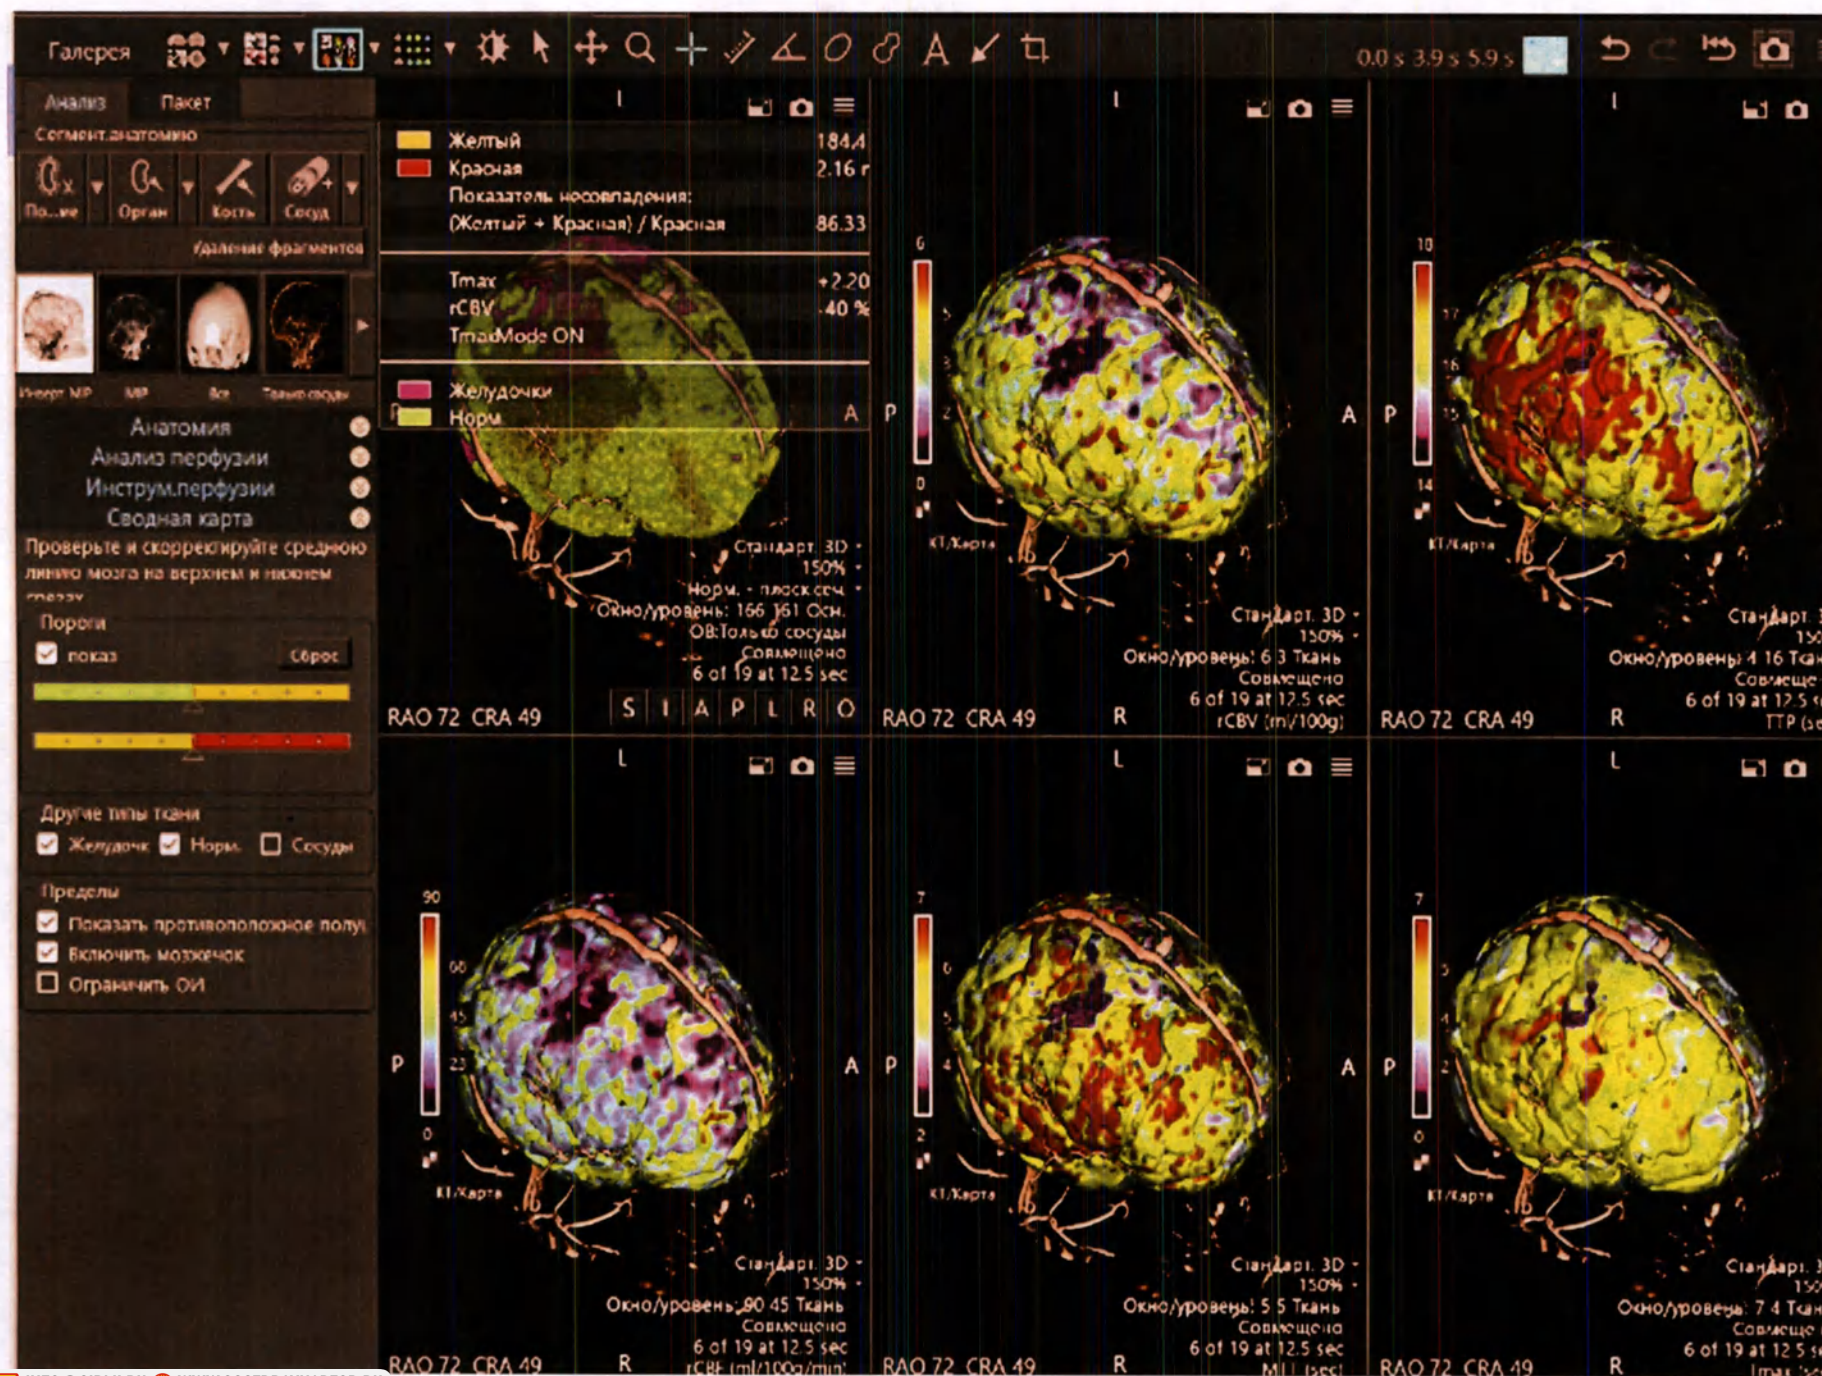


22. Программный пакет Vitrea CT Package №4 с набором опций для анализа легких (при необходимости) (Приложение для улучшения качества изображений)

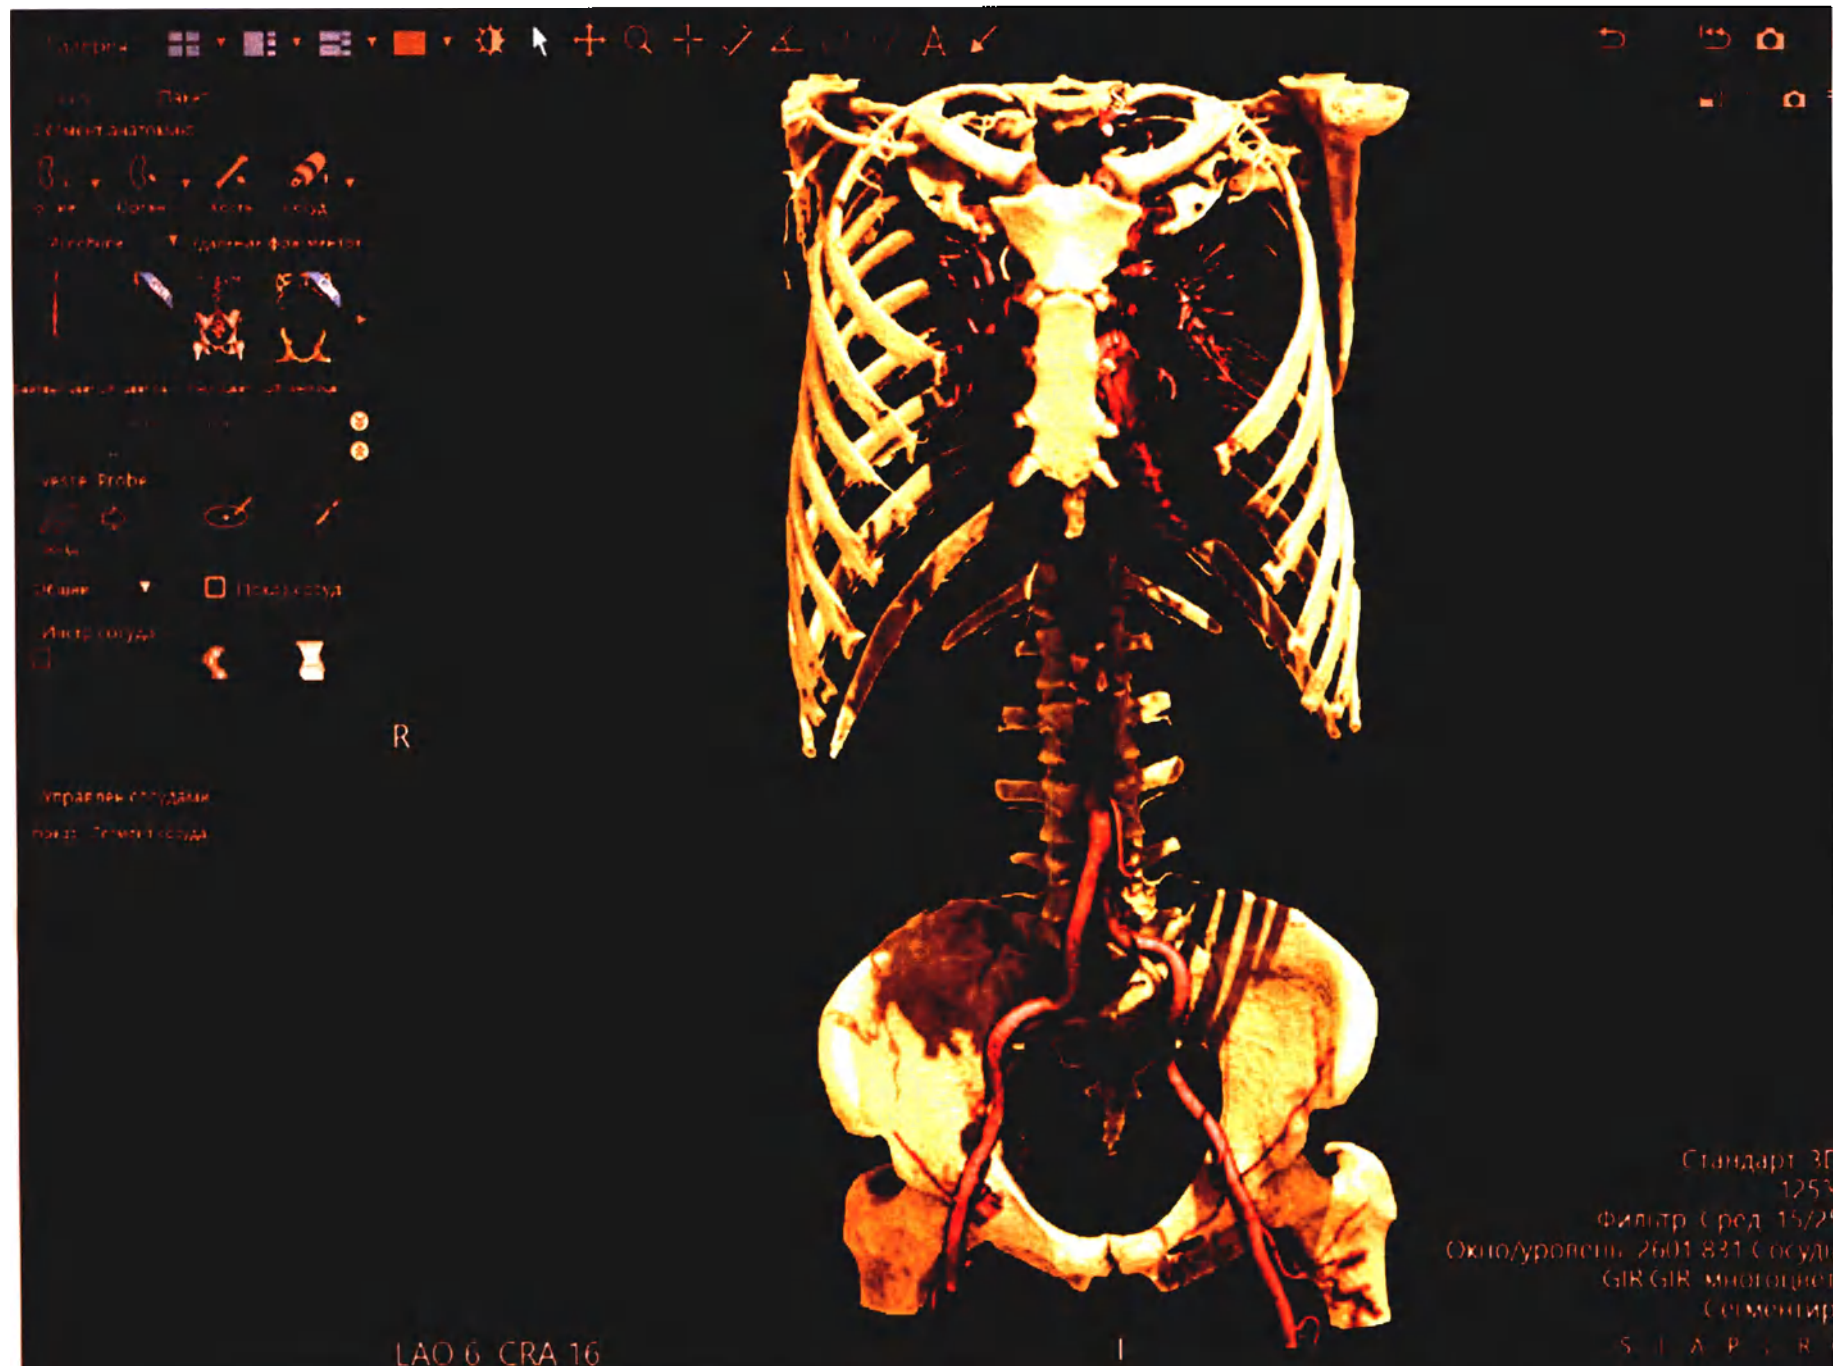


23. Программный пакет для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)




23. Программный пакет для анализа легких (при необходимости) (Приложение для анализа плотности легочной ткани)

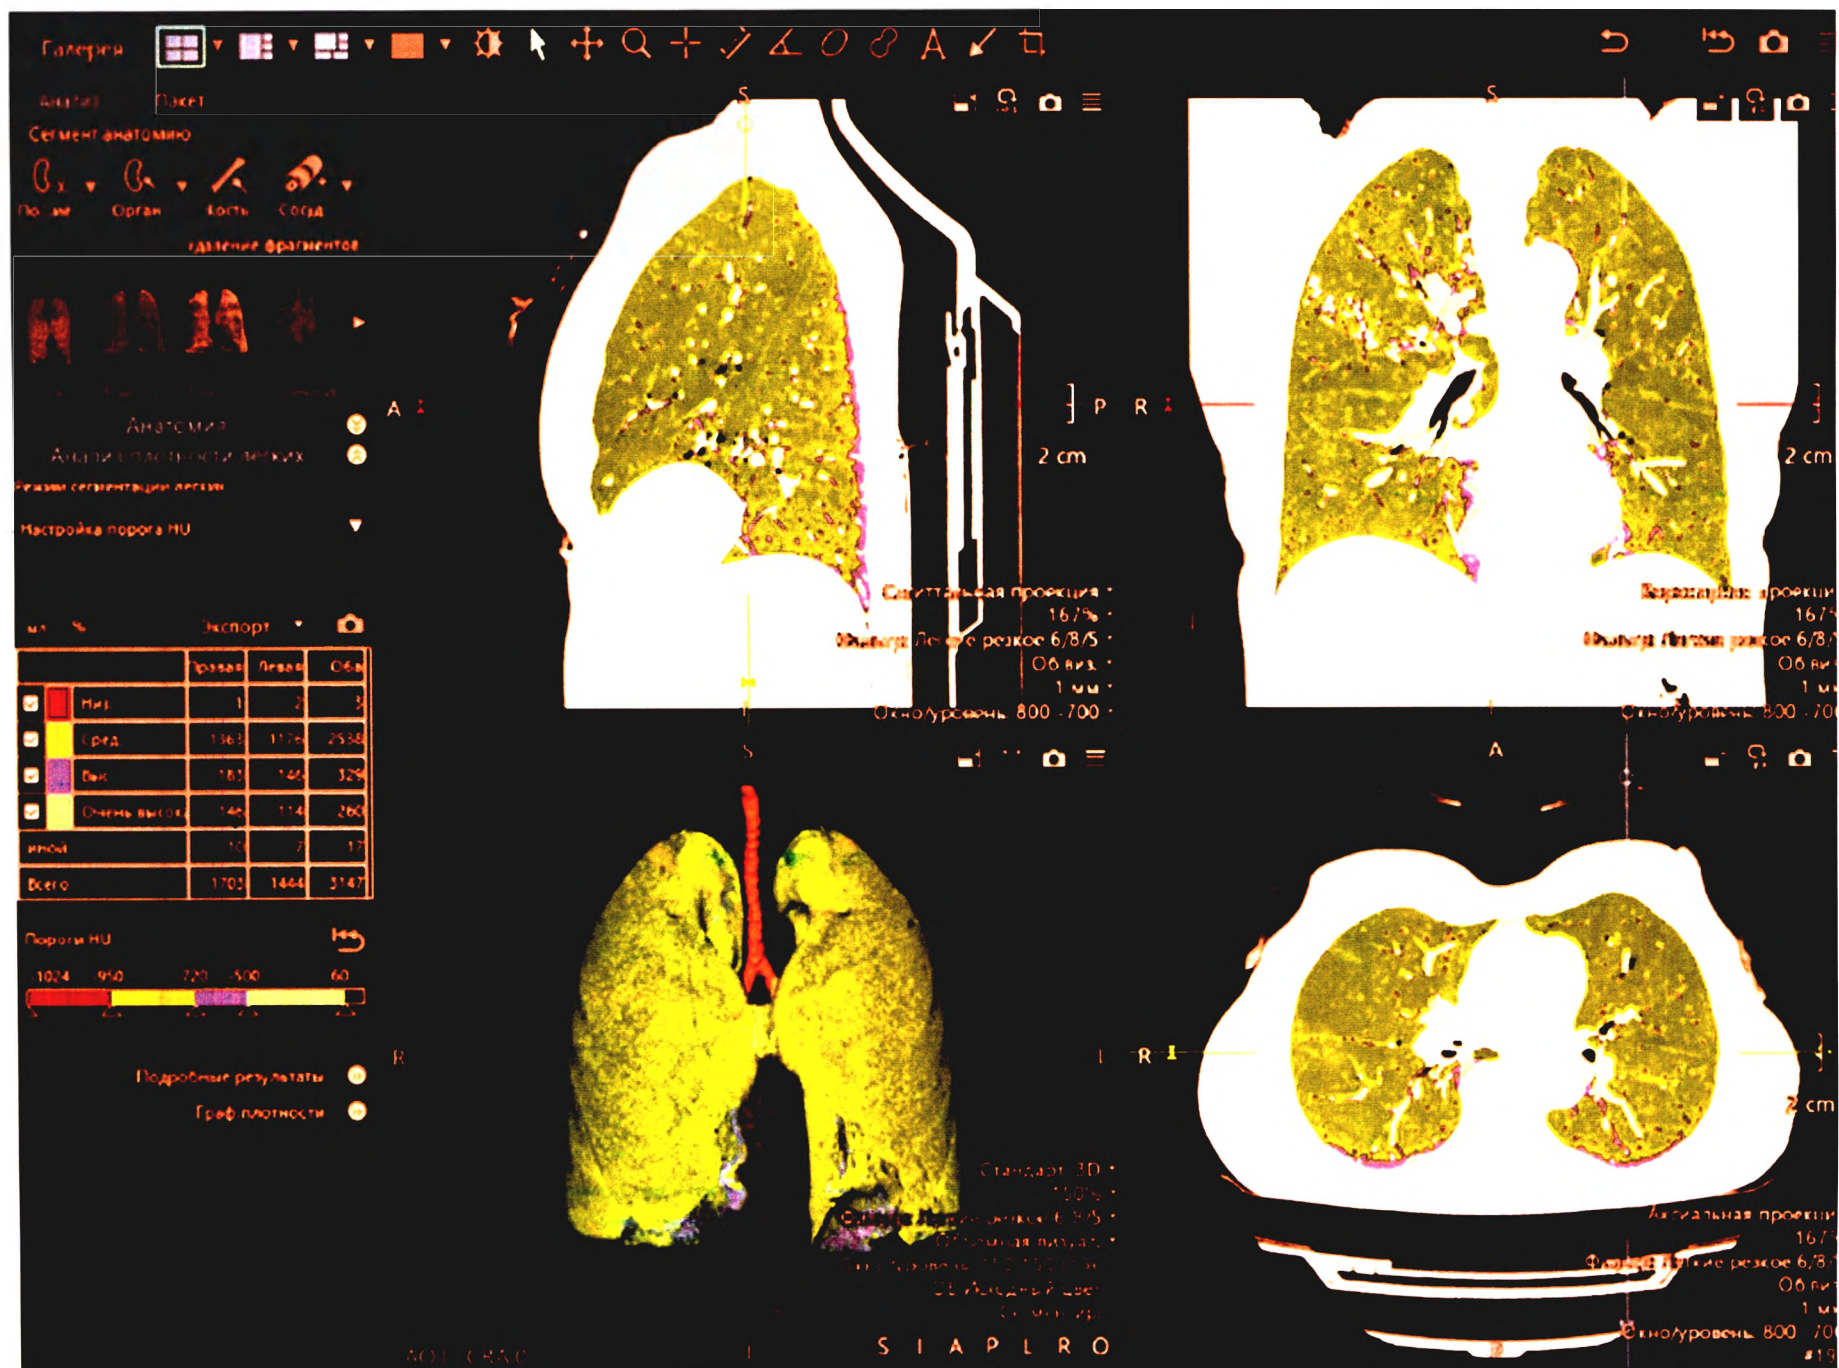


23. Программный пакет для анализа легких (при необходимости) (Приложение для улучшения качества изображений)

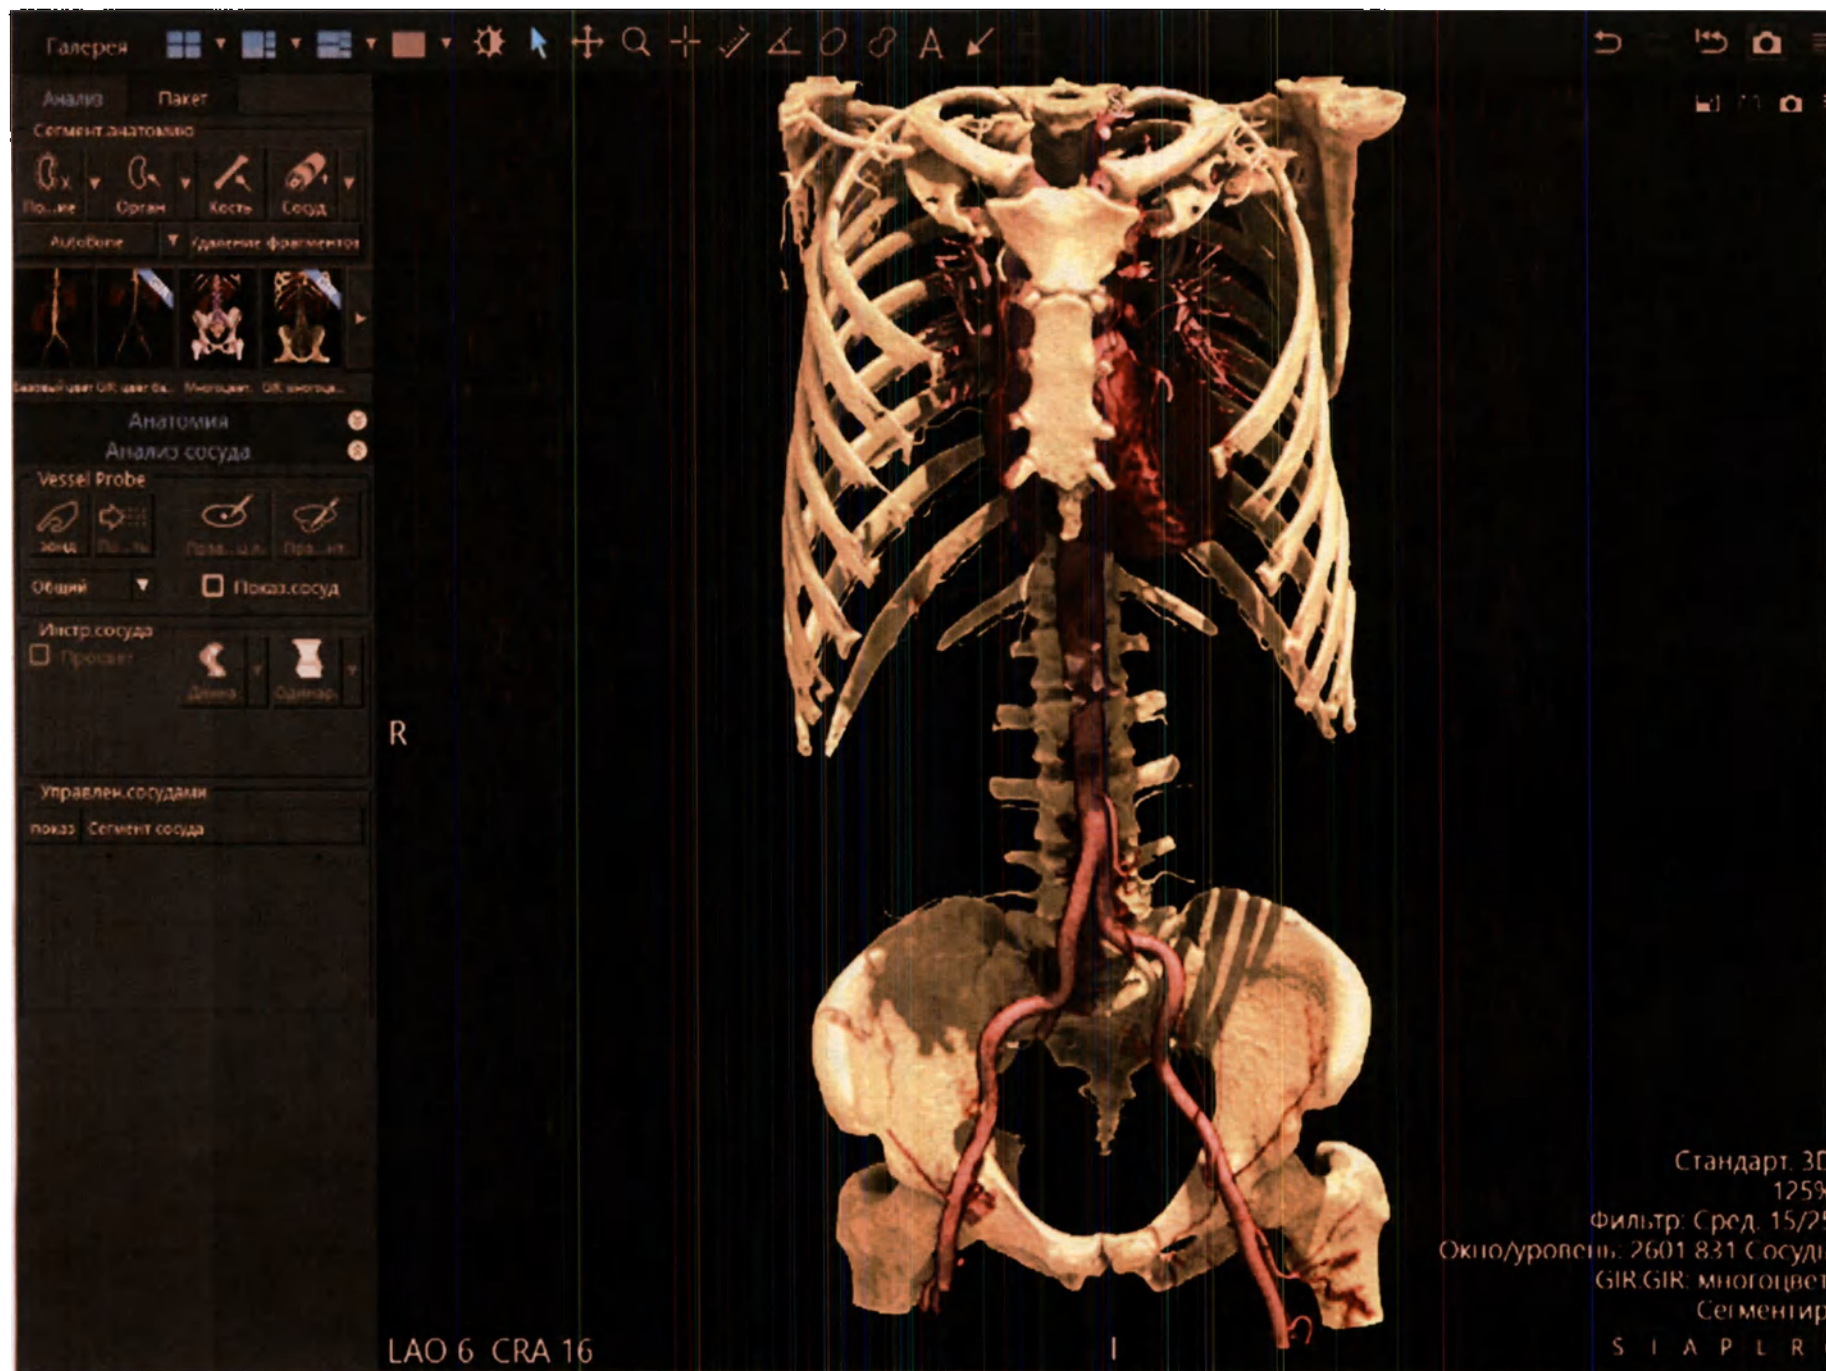


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для электрофизиологического планирования)

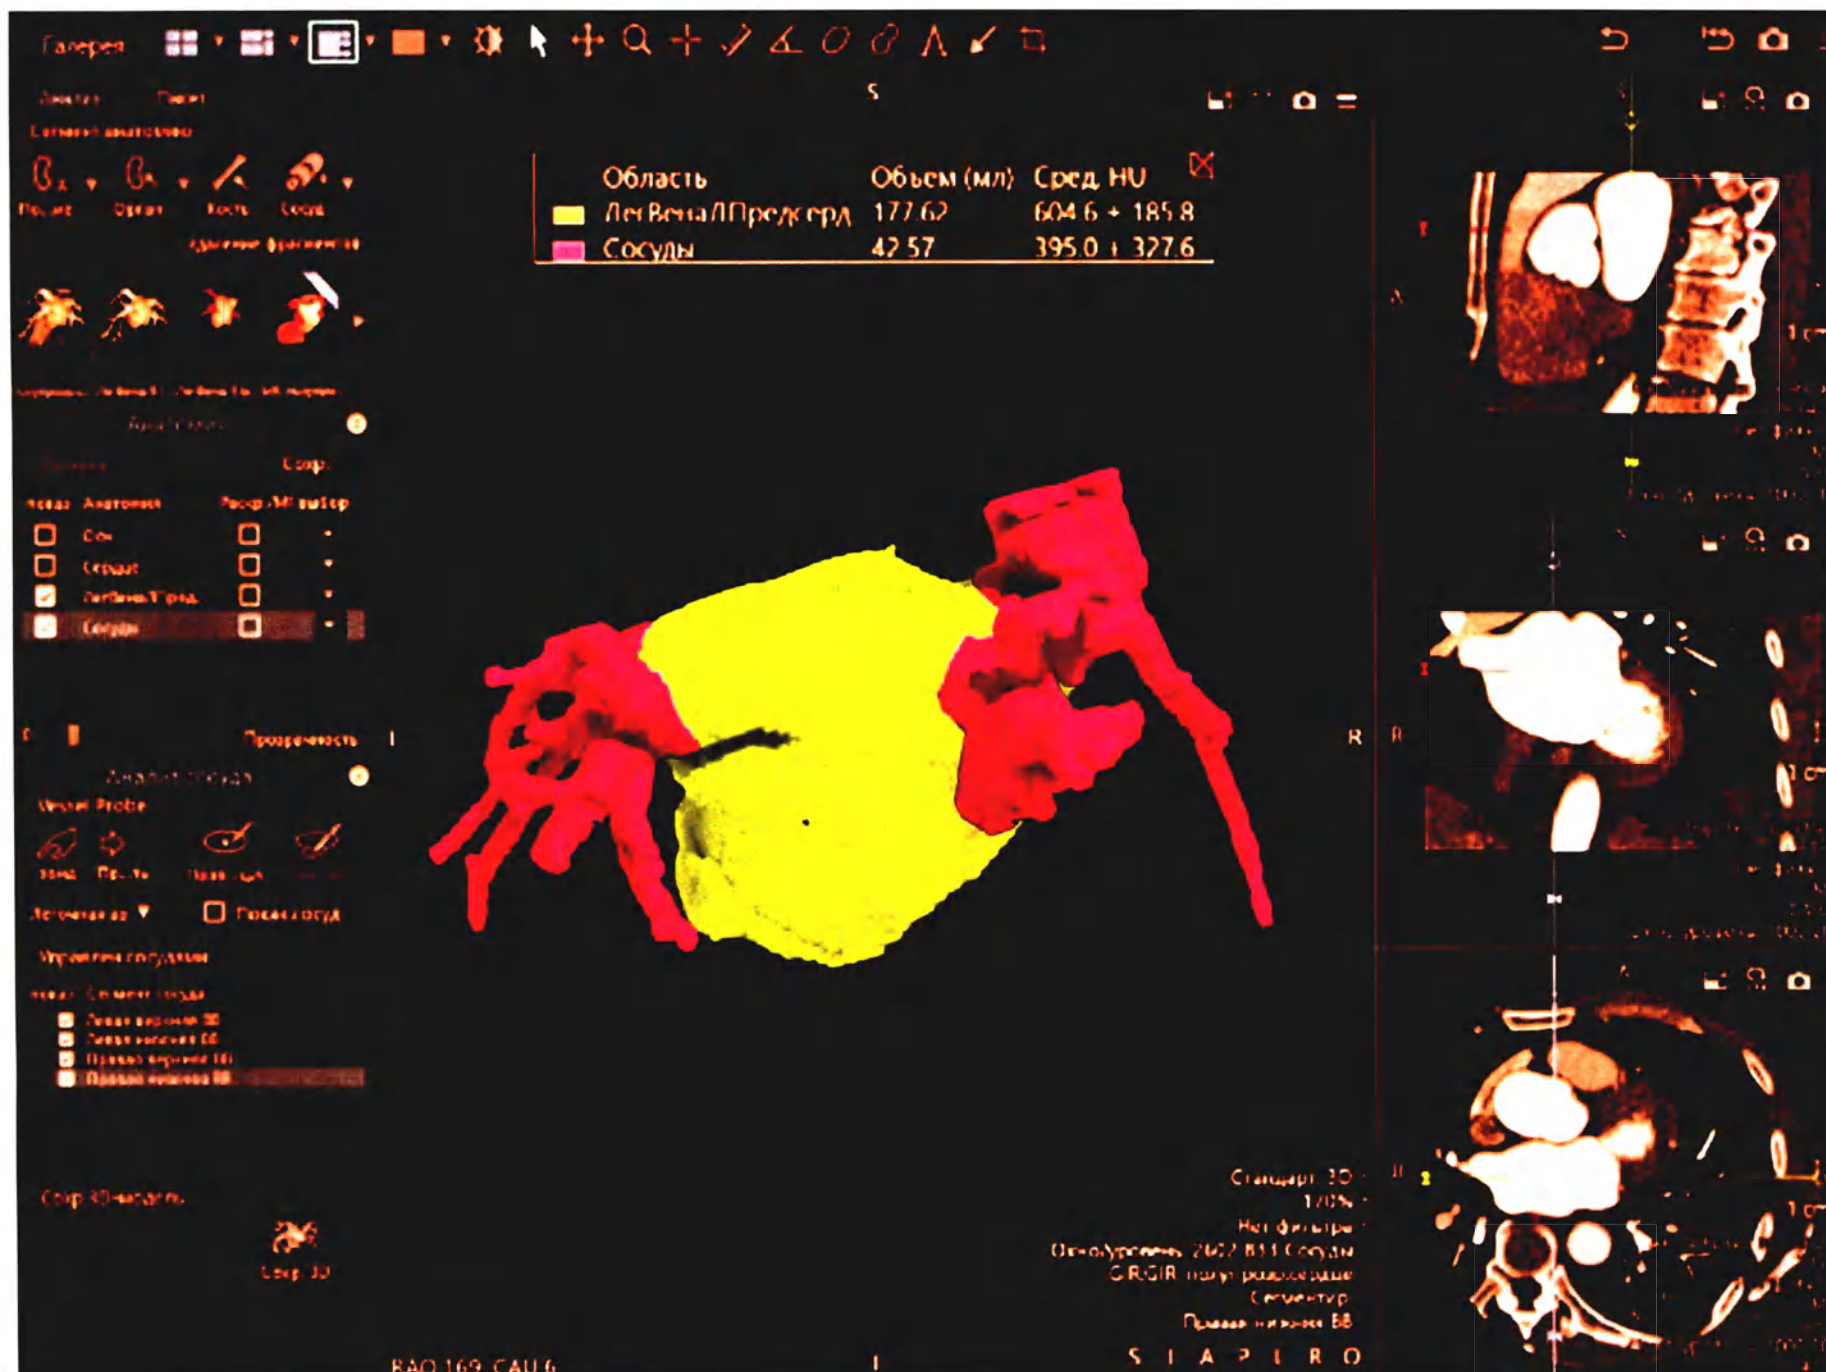


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для планирования установки стента)

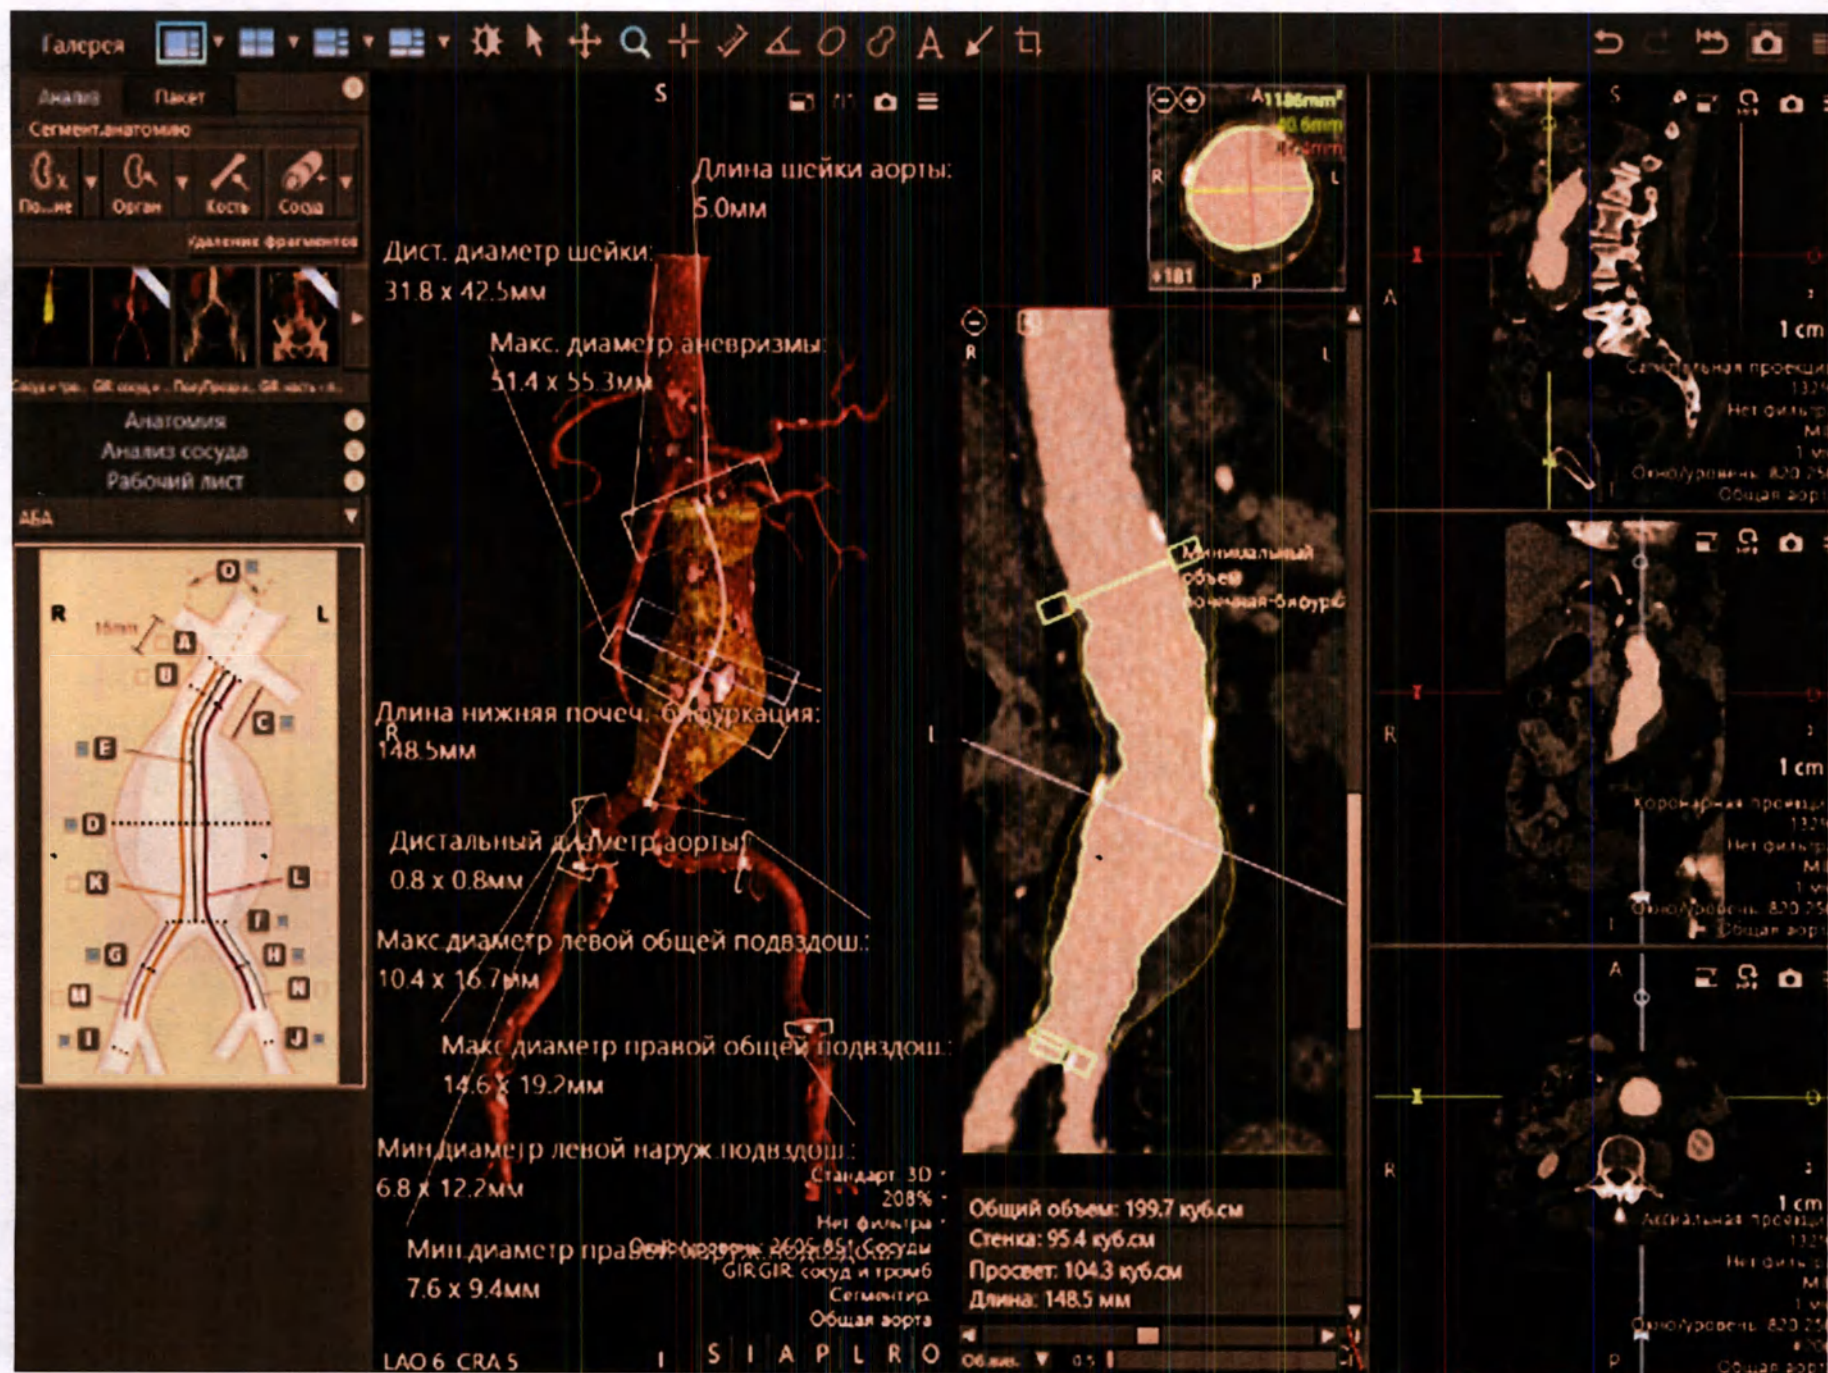


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа печени)

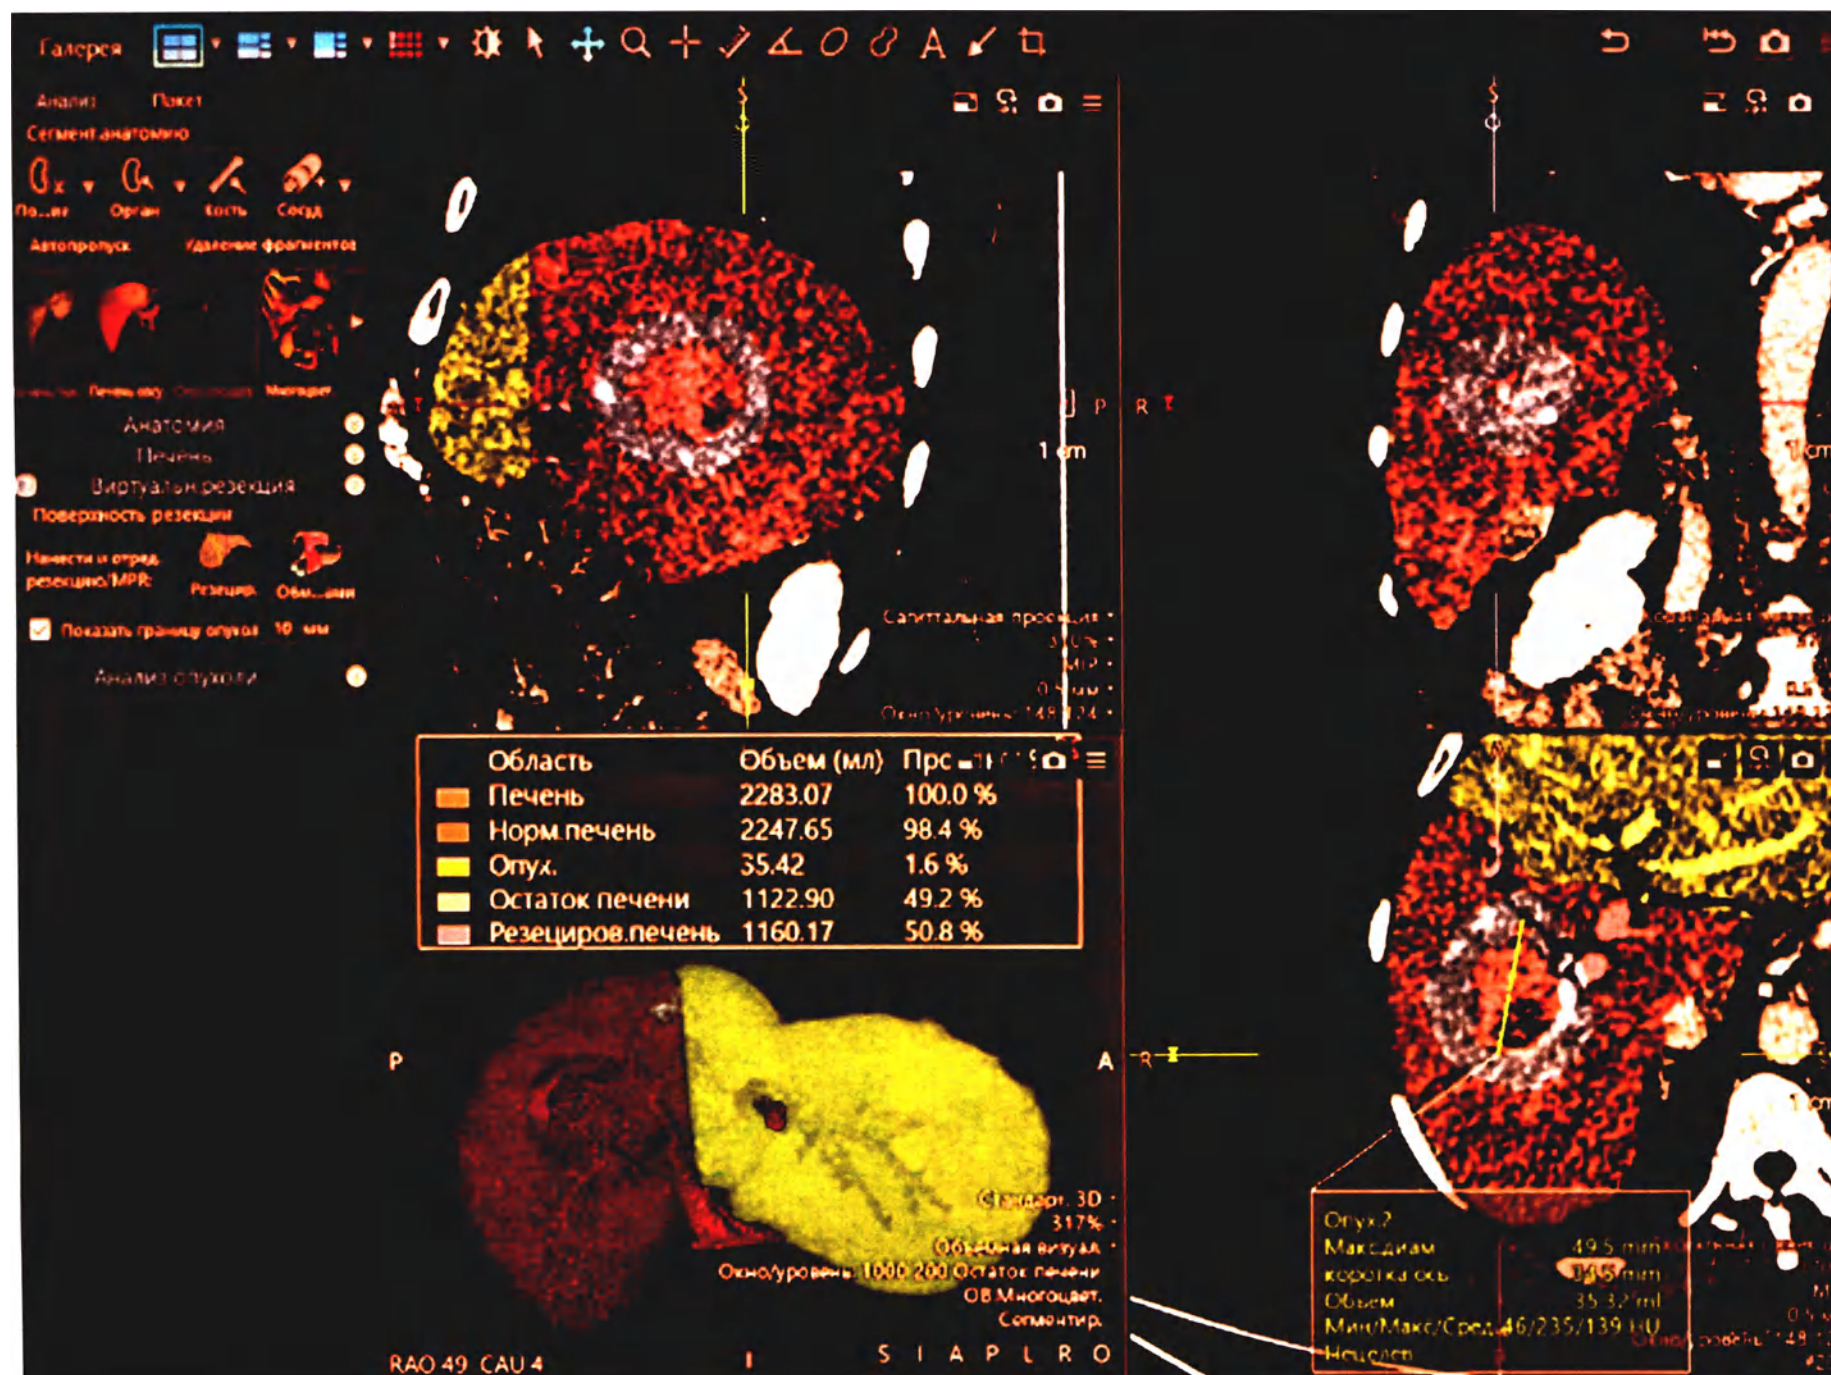

24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для планирования внутрисосудистых манипуляций)

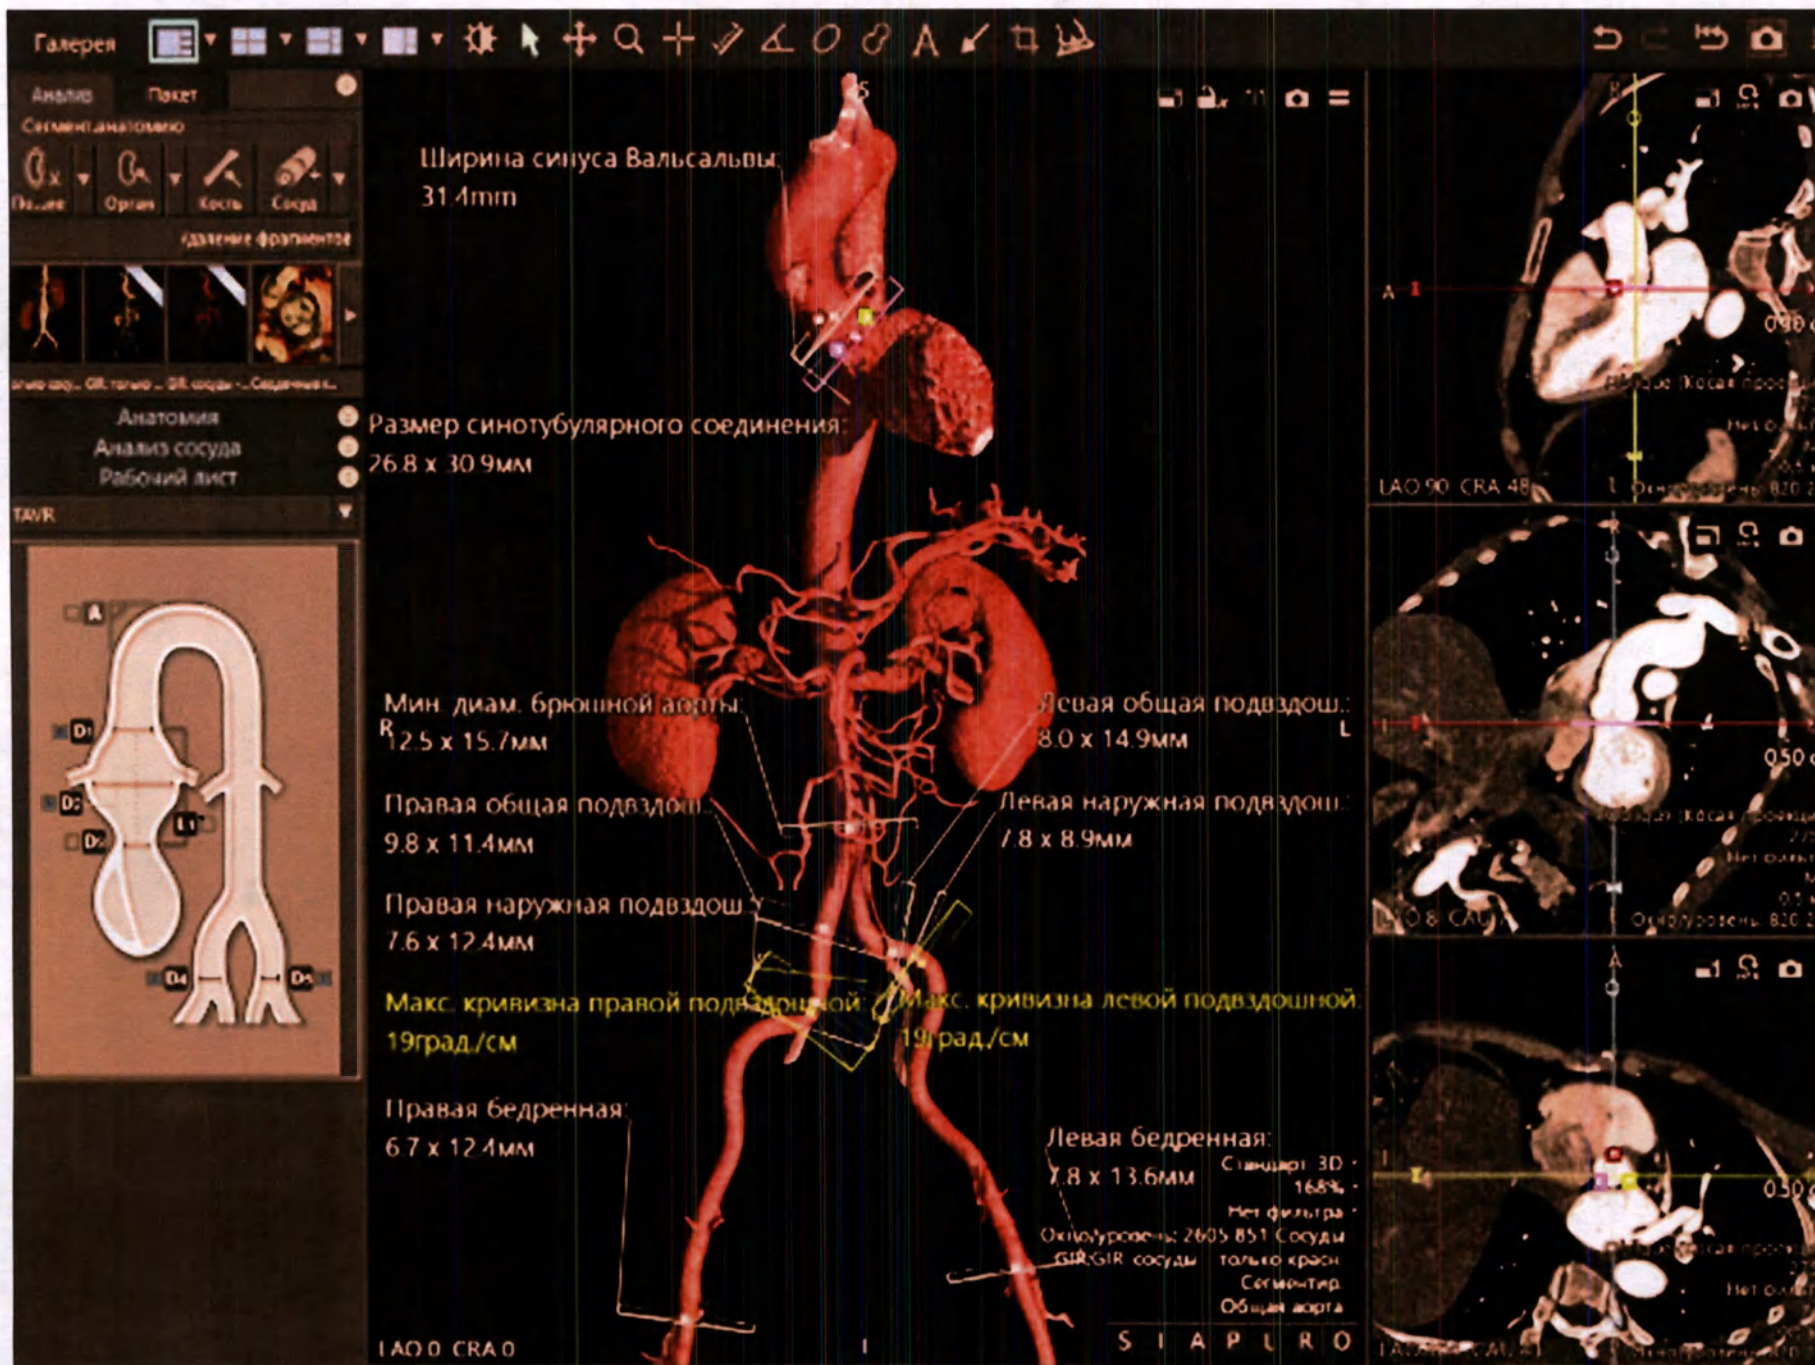


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для виртуальной колоноскопии)

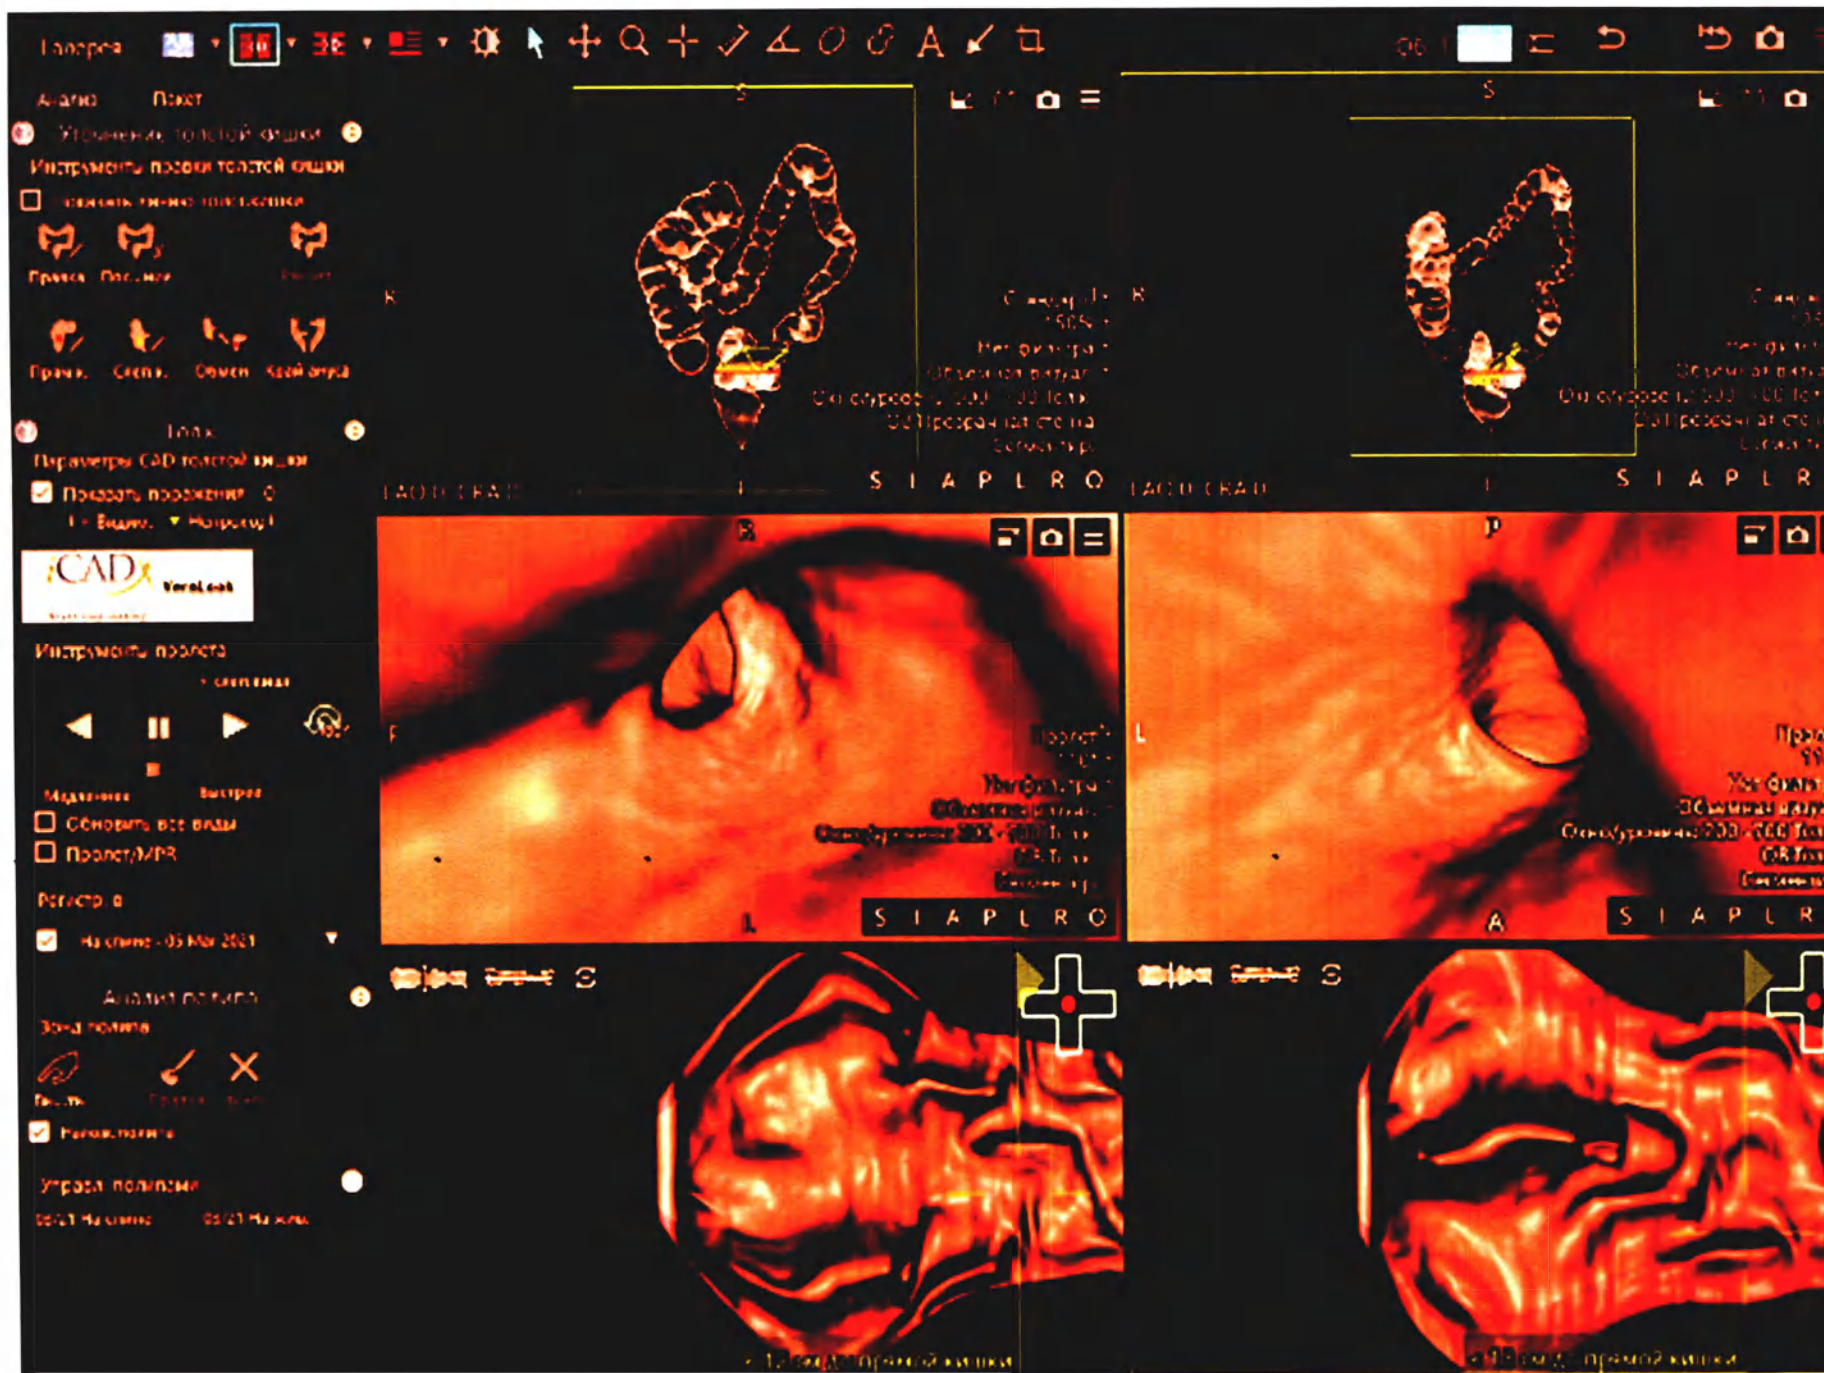


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа узелковых образований легких)




24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа плотности легочной ткани)

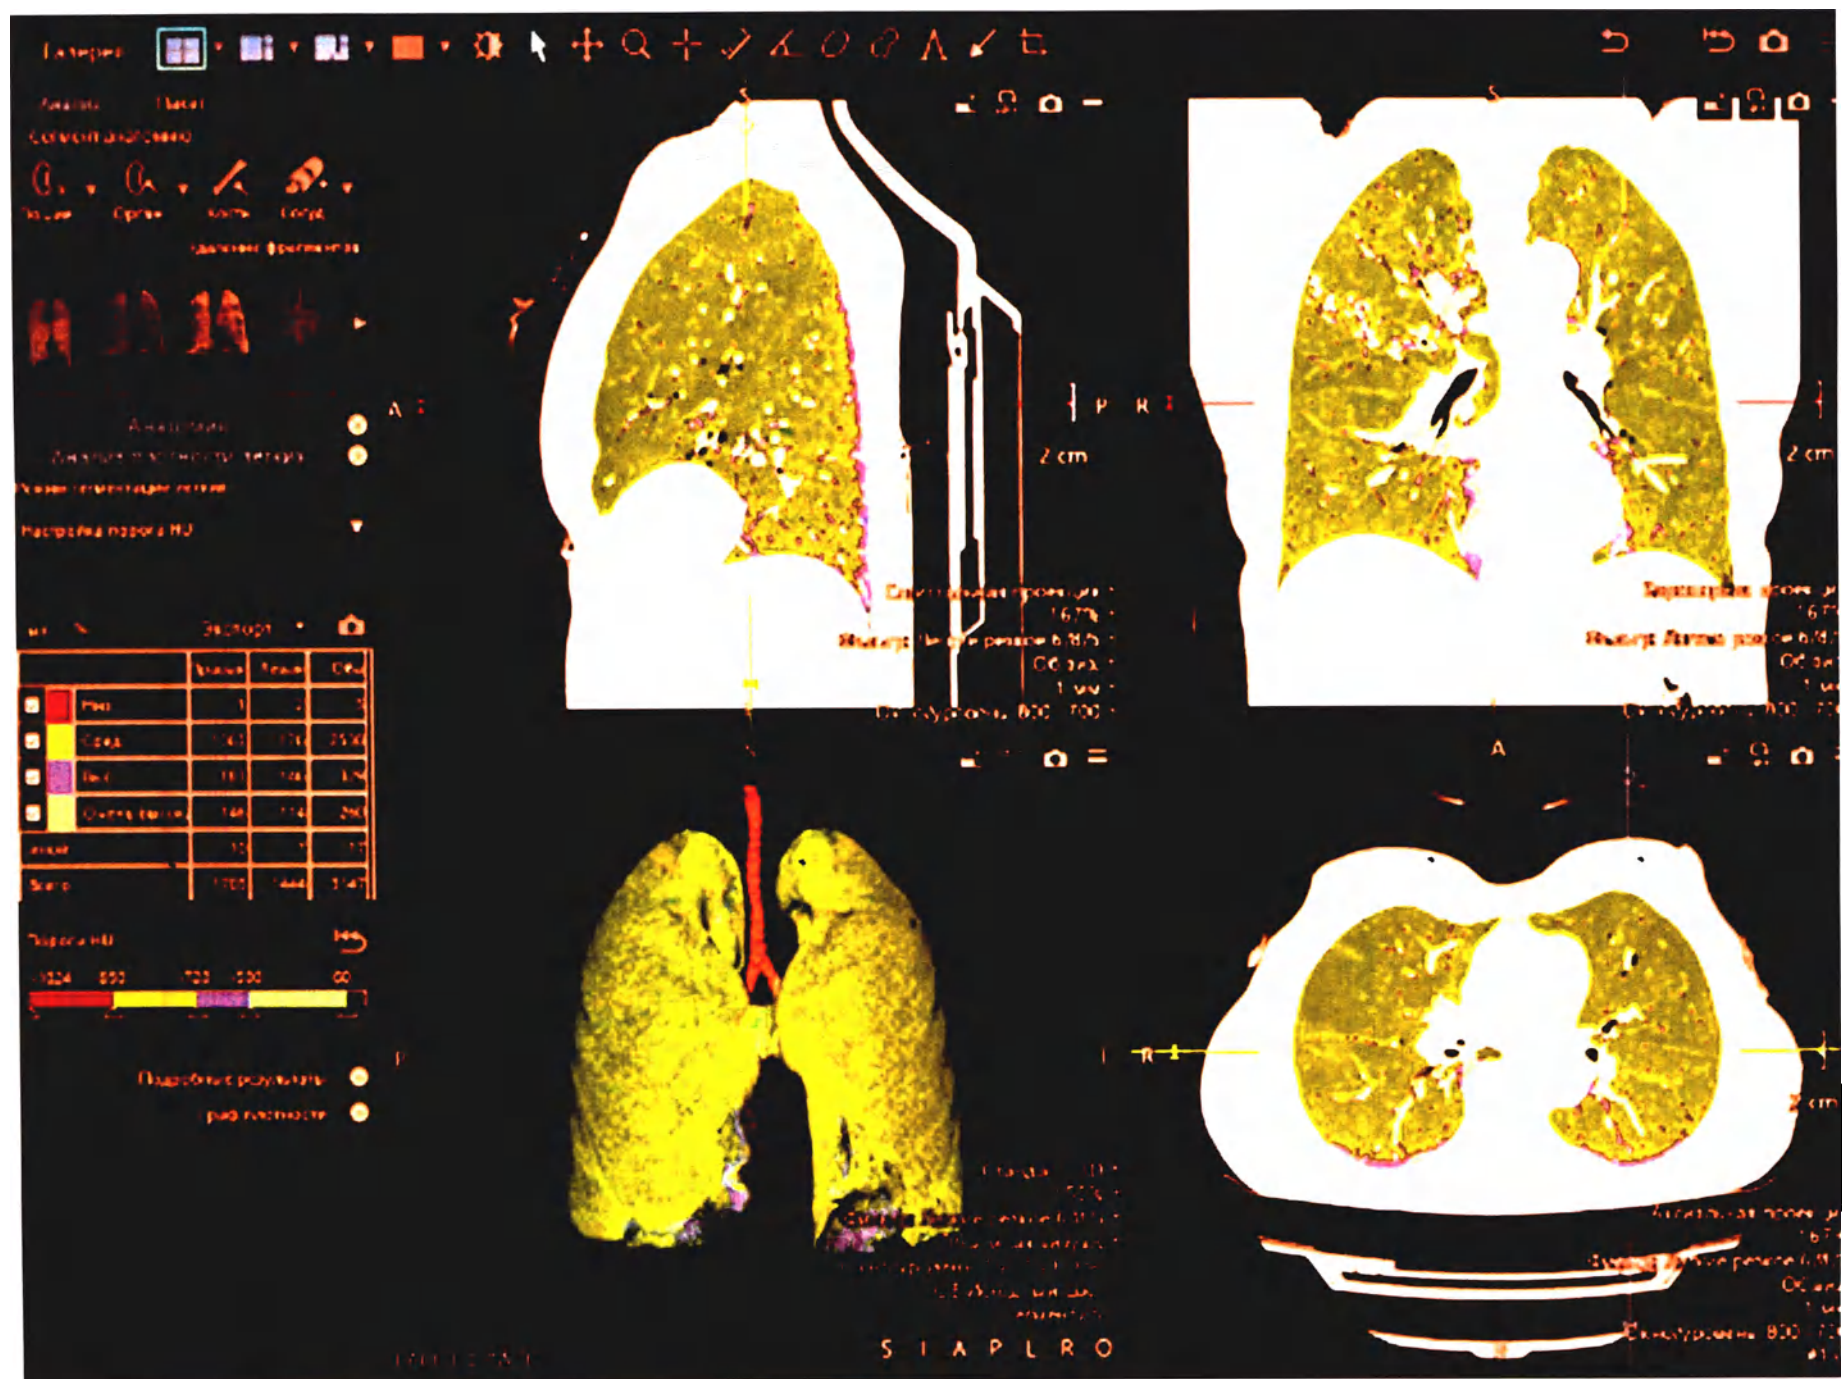


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа перфузии головного мозга)

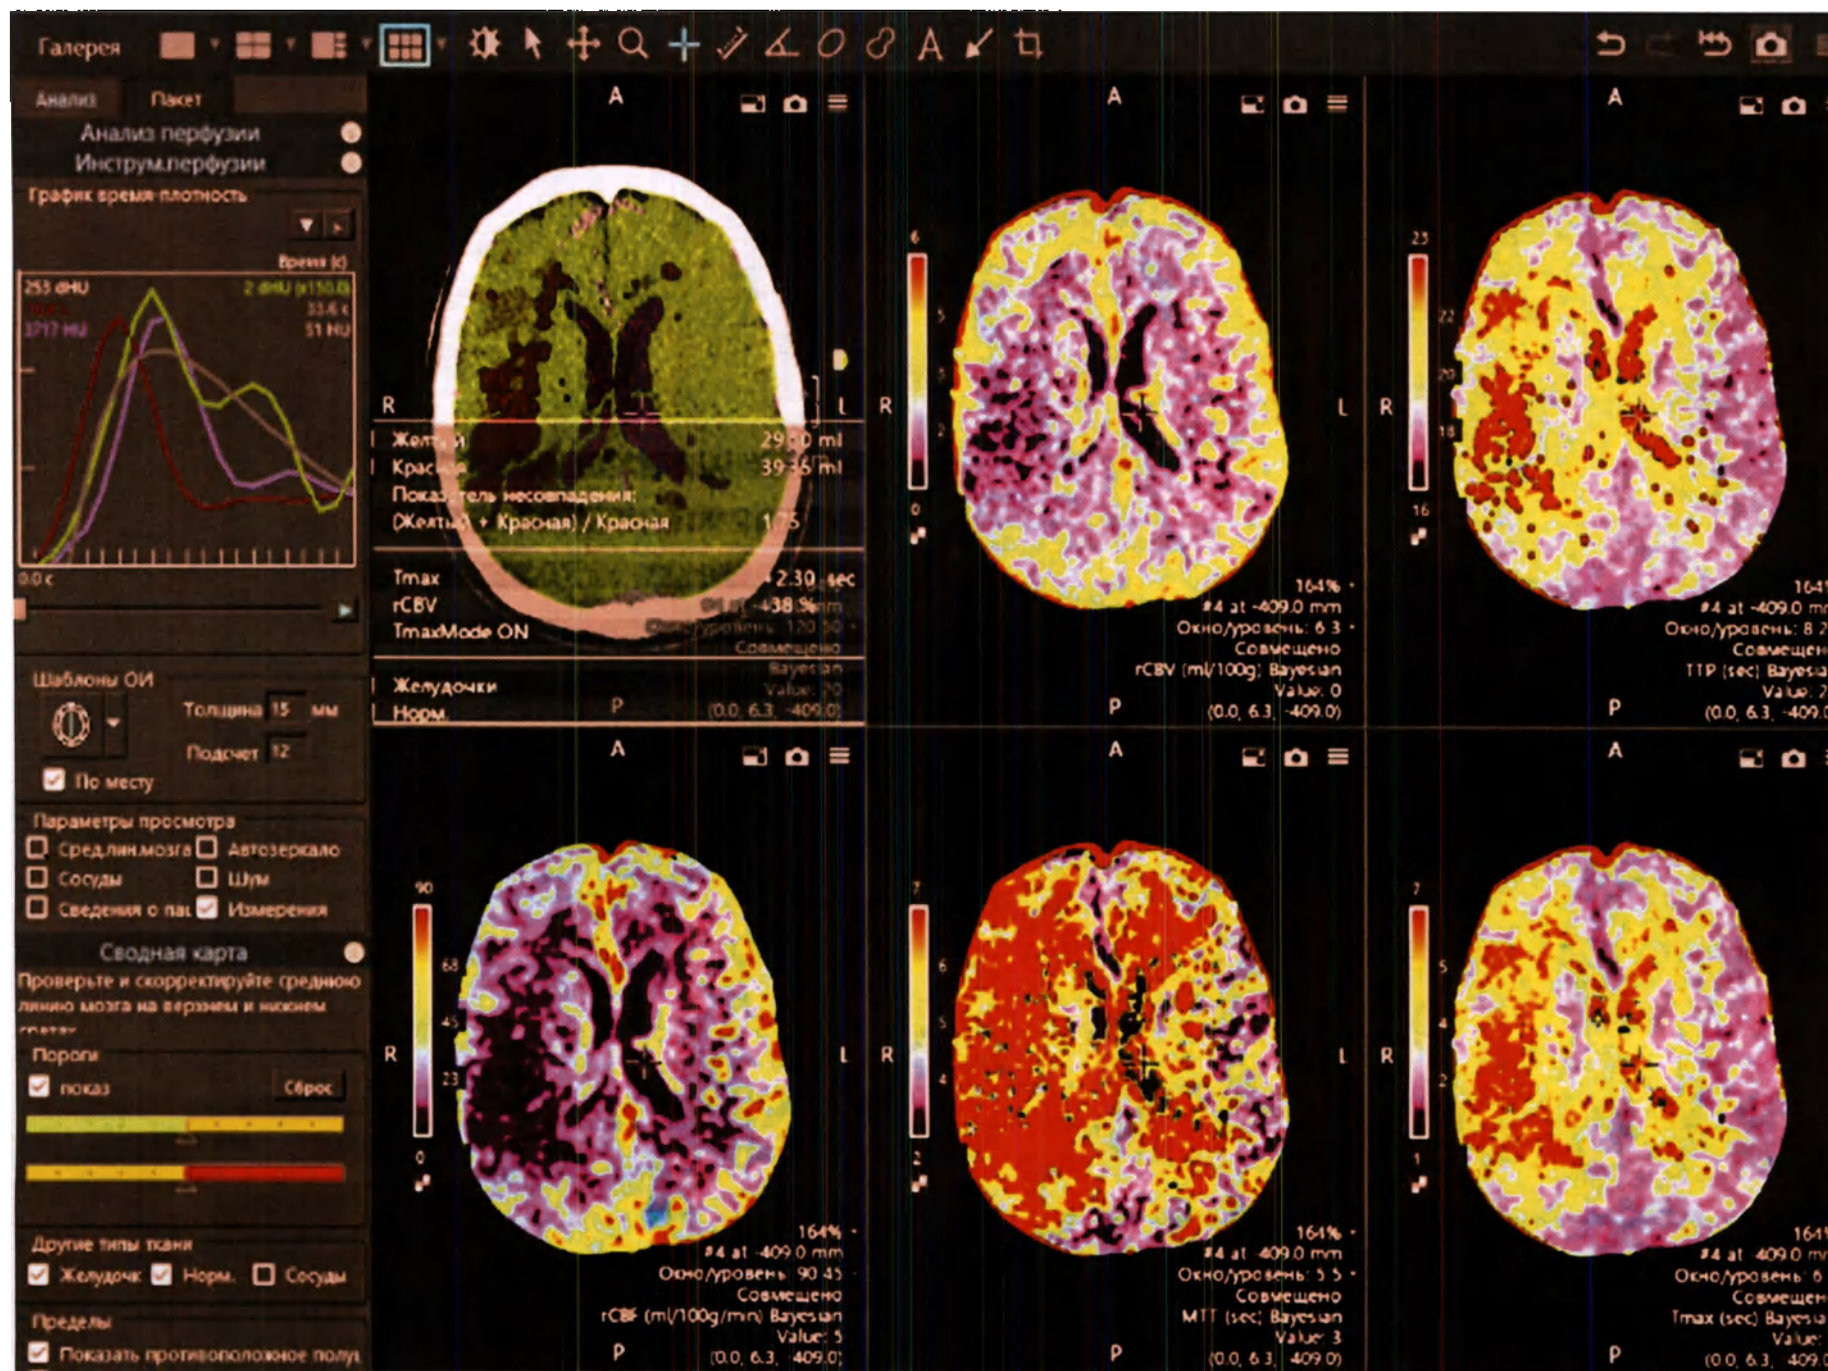


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для оценки содержания кальция)

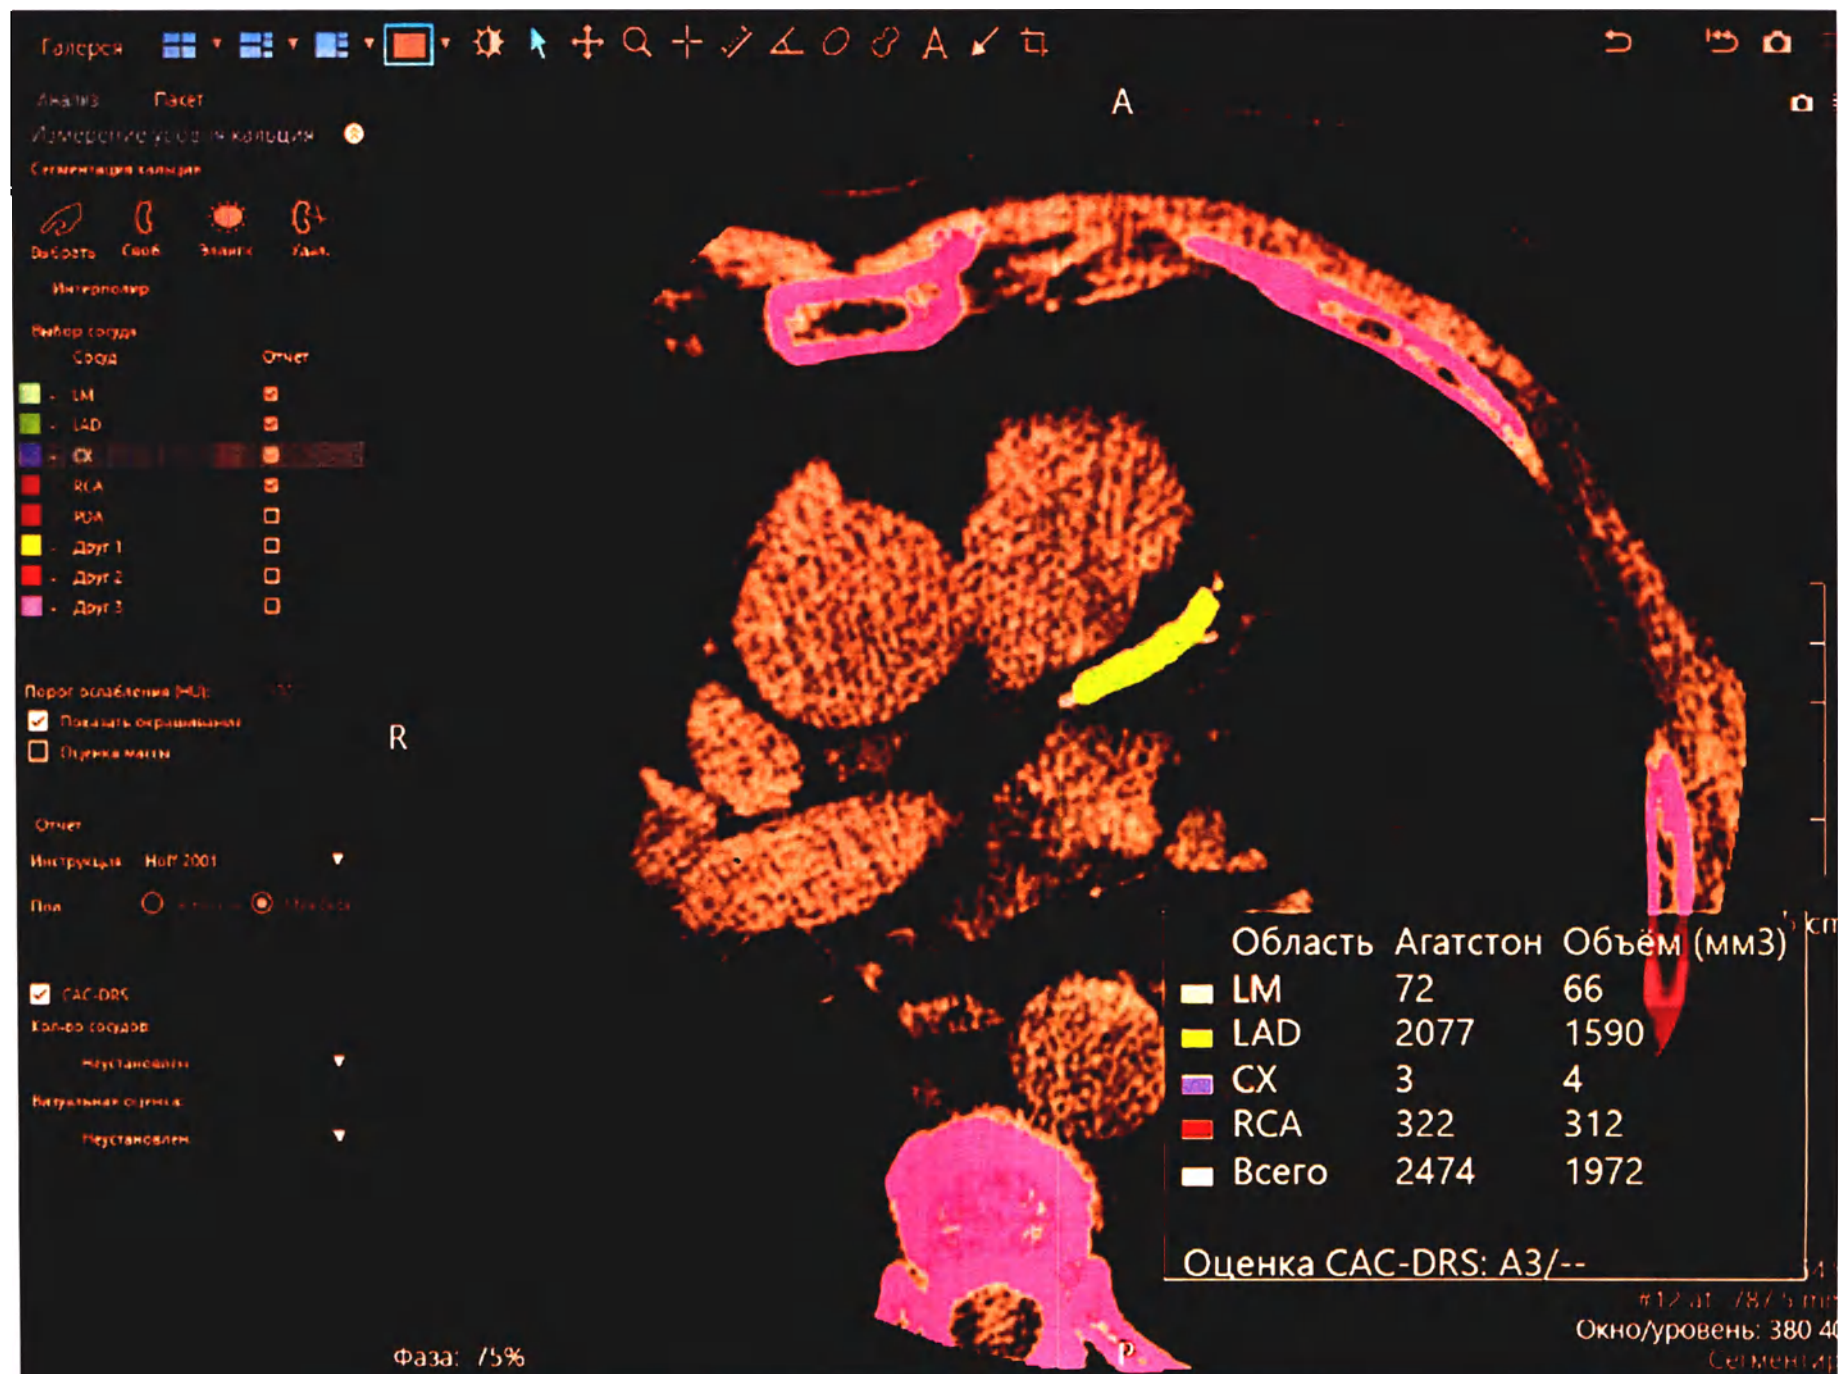


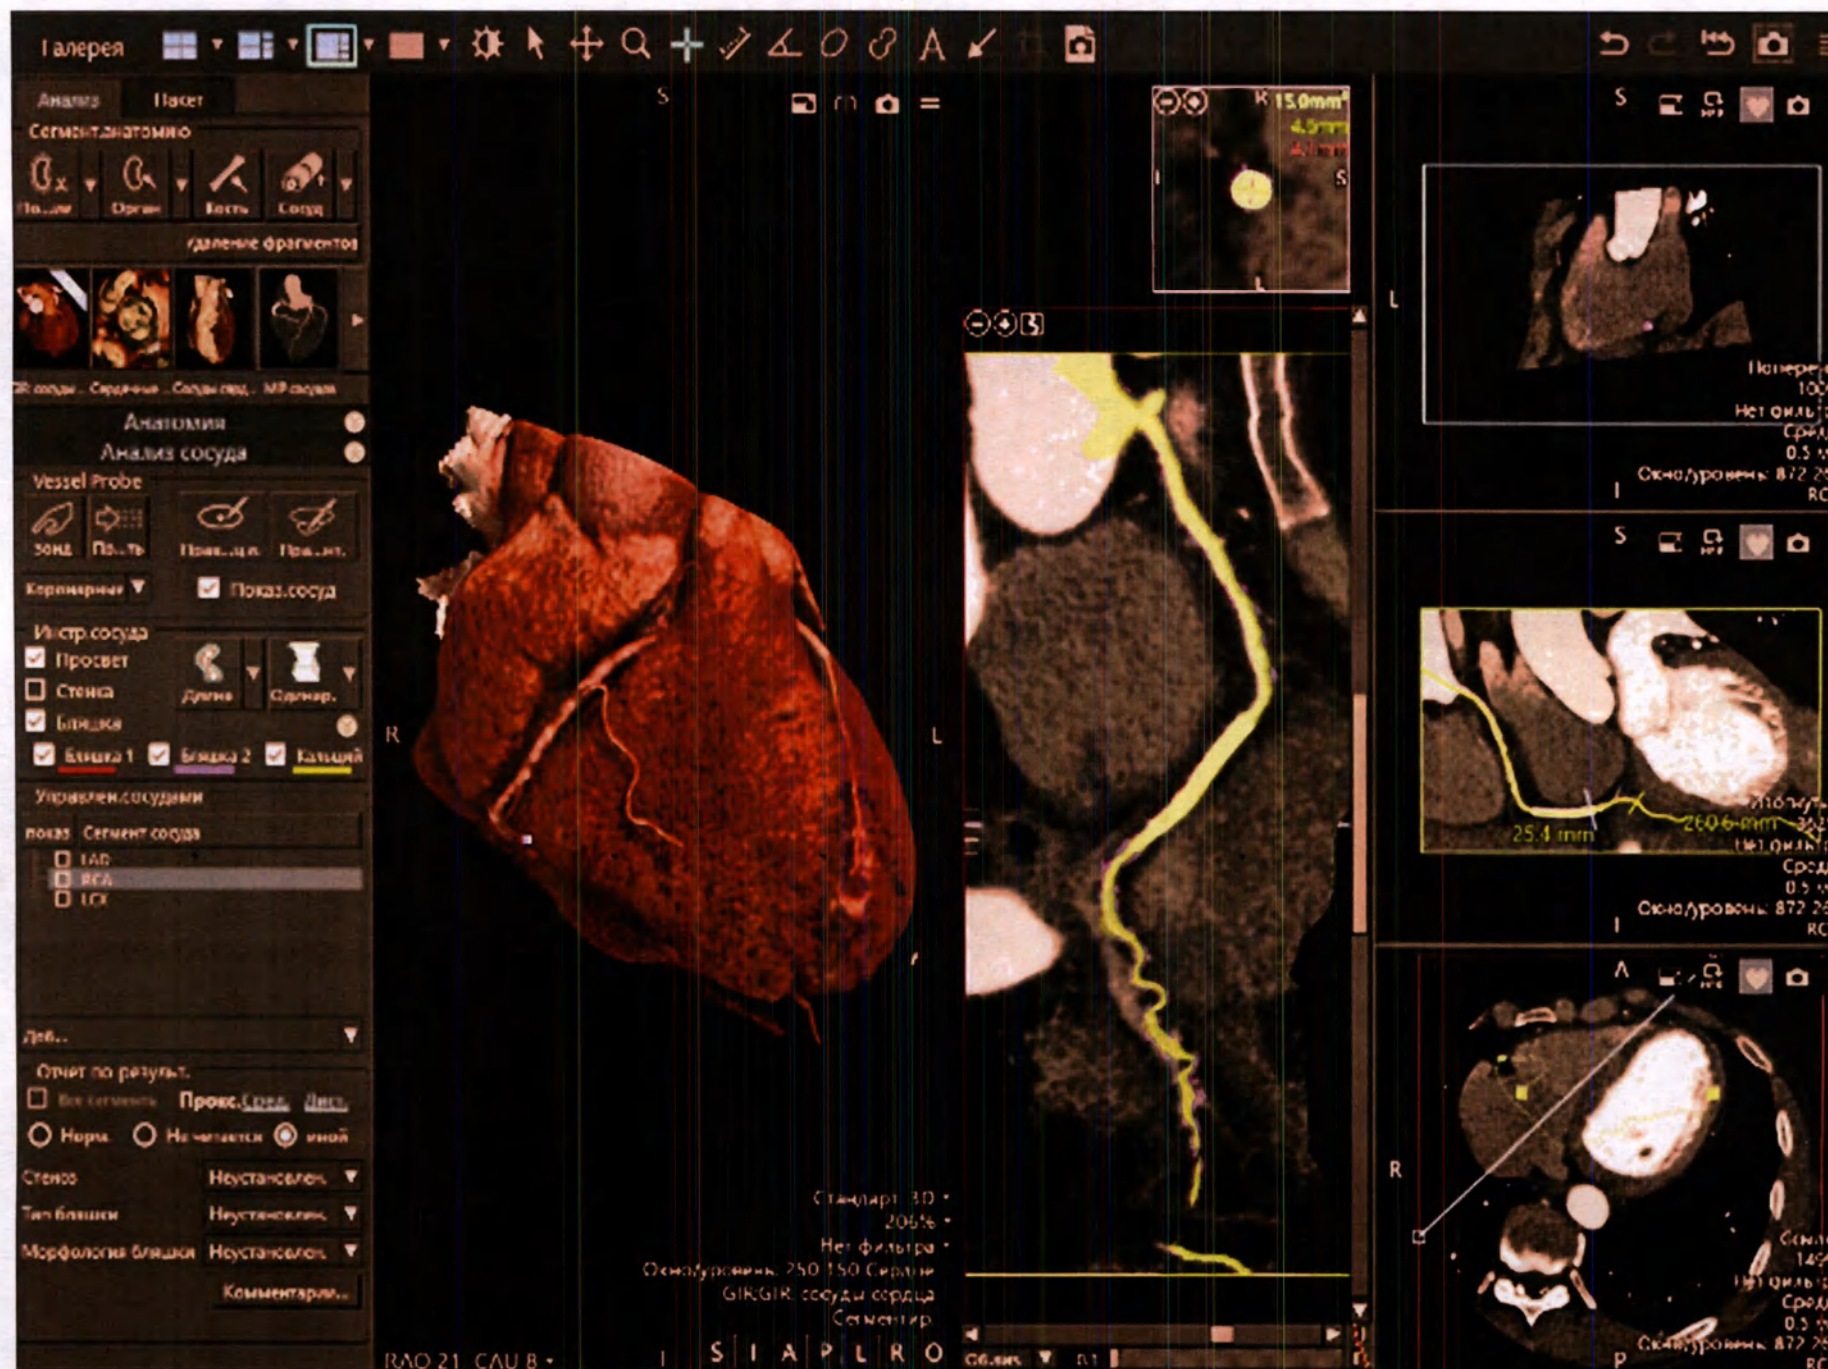


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для функционального анализа сердца)

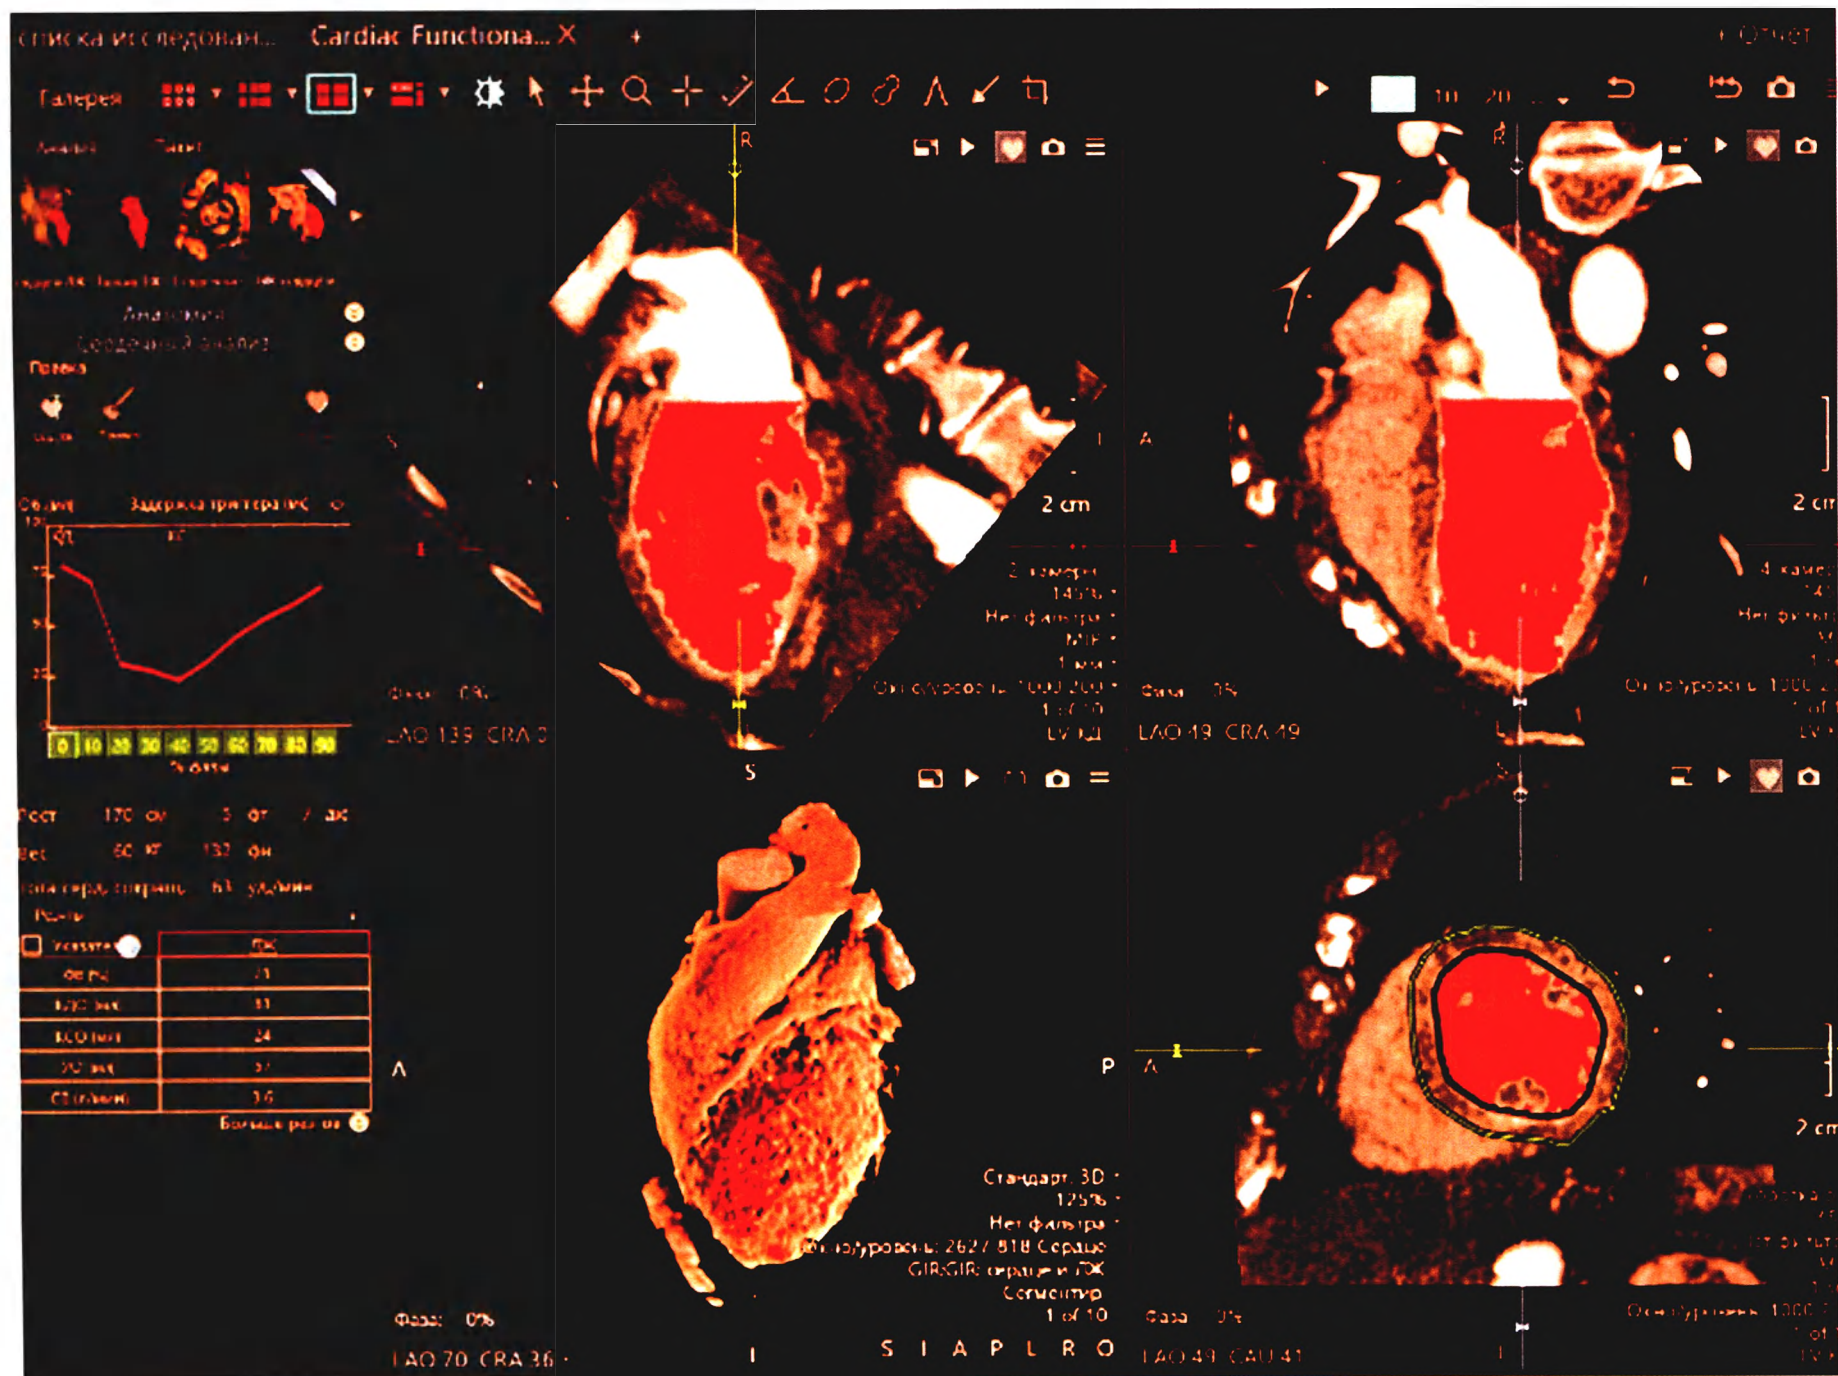


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для многокамерного анализа функции сердца)

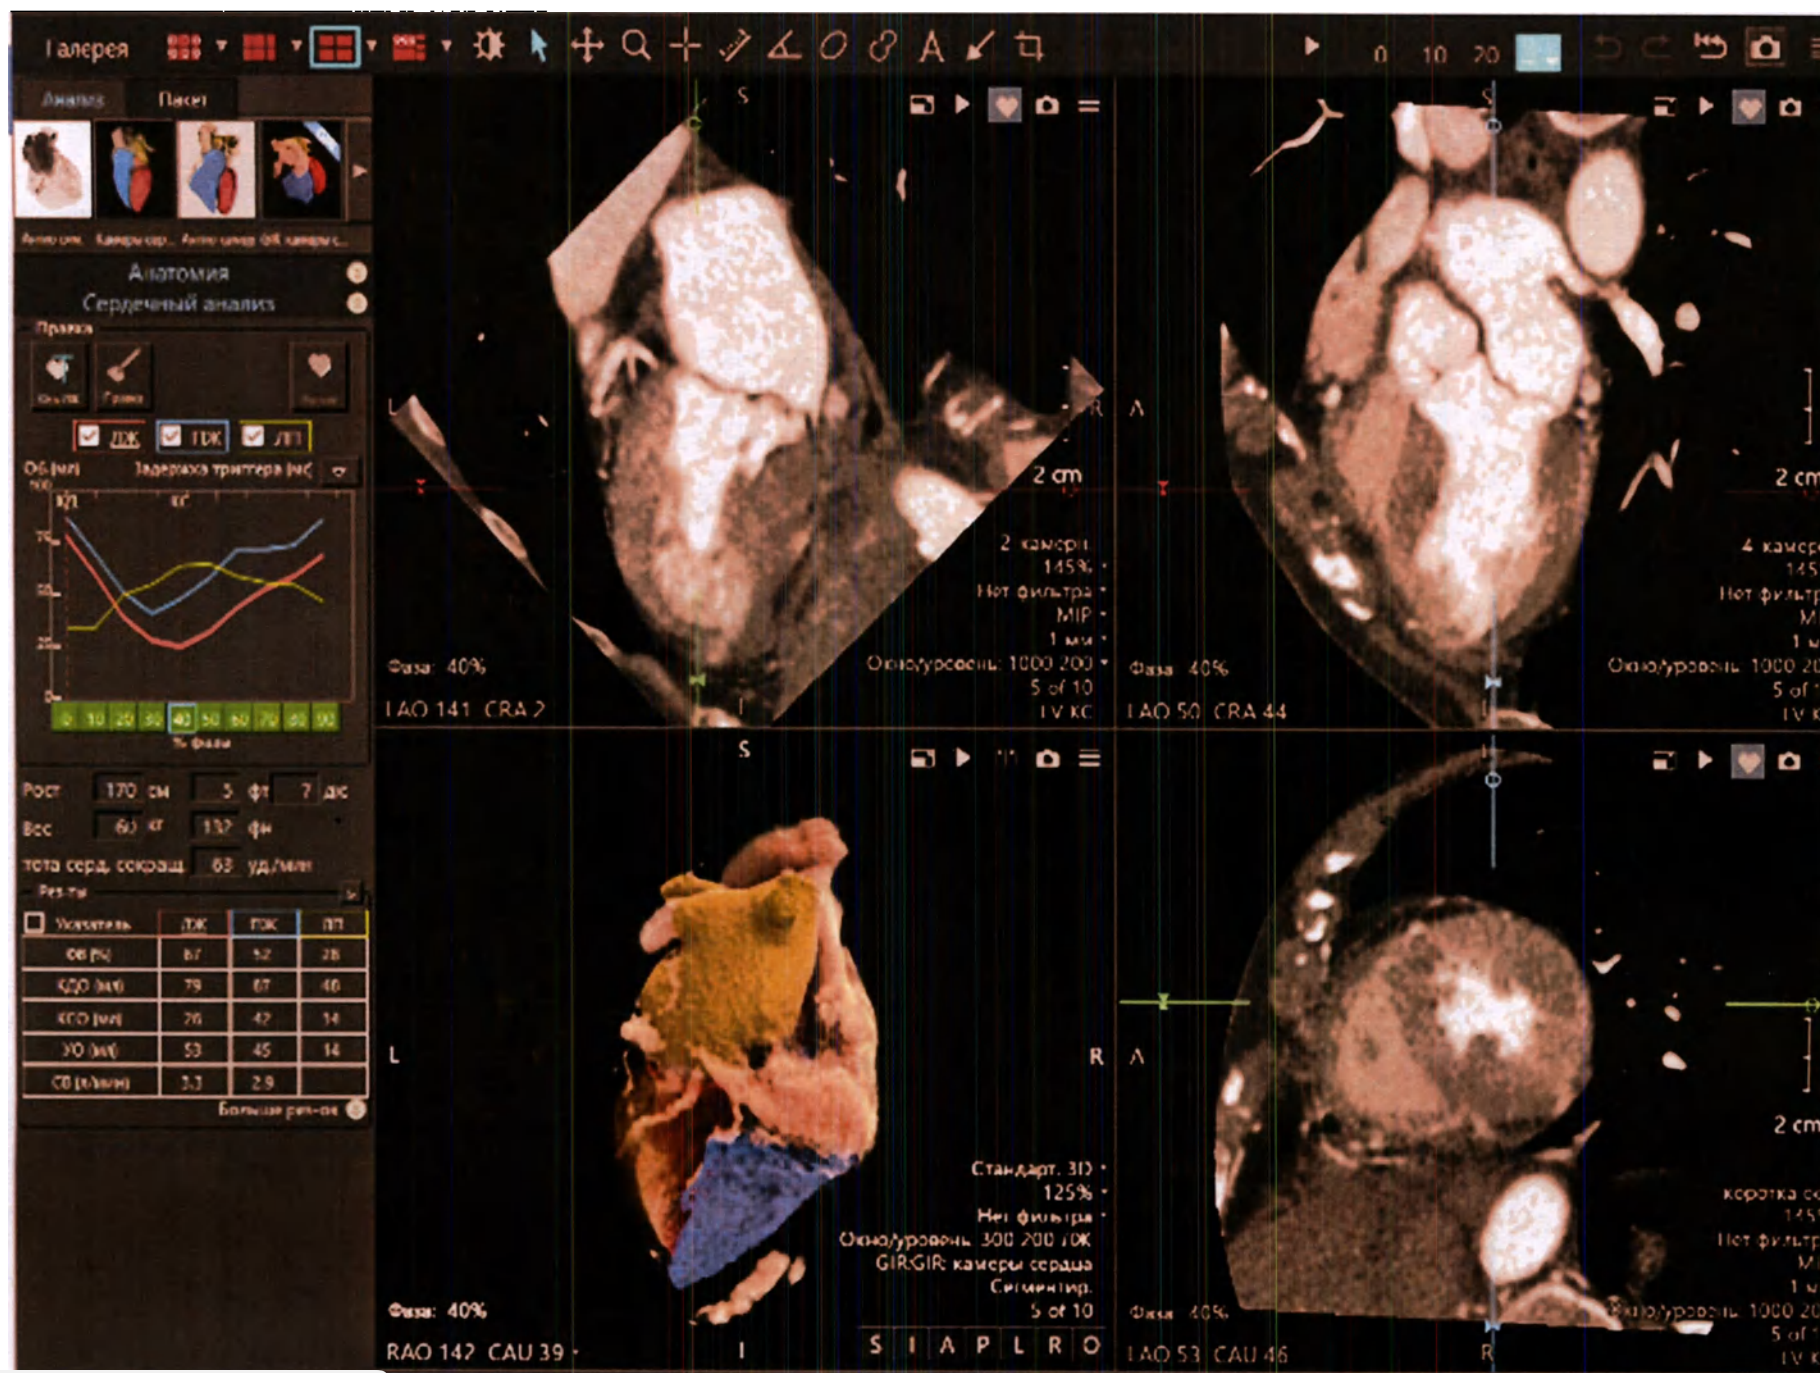


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для определения жирового индекса)

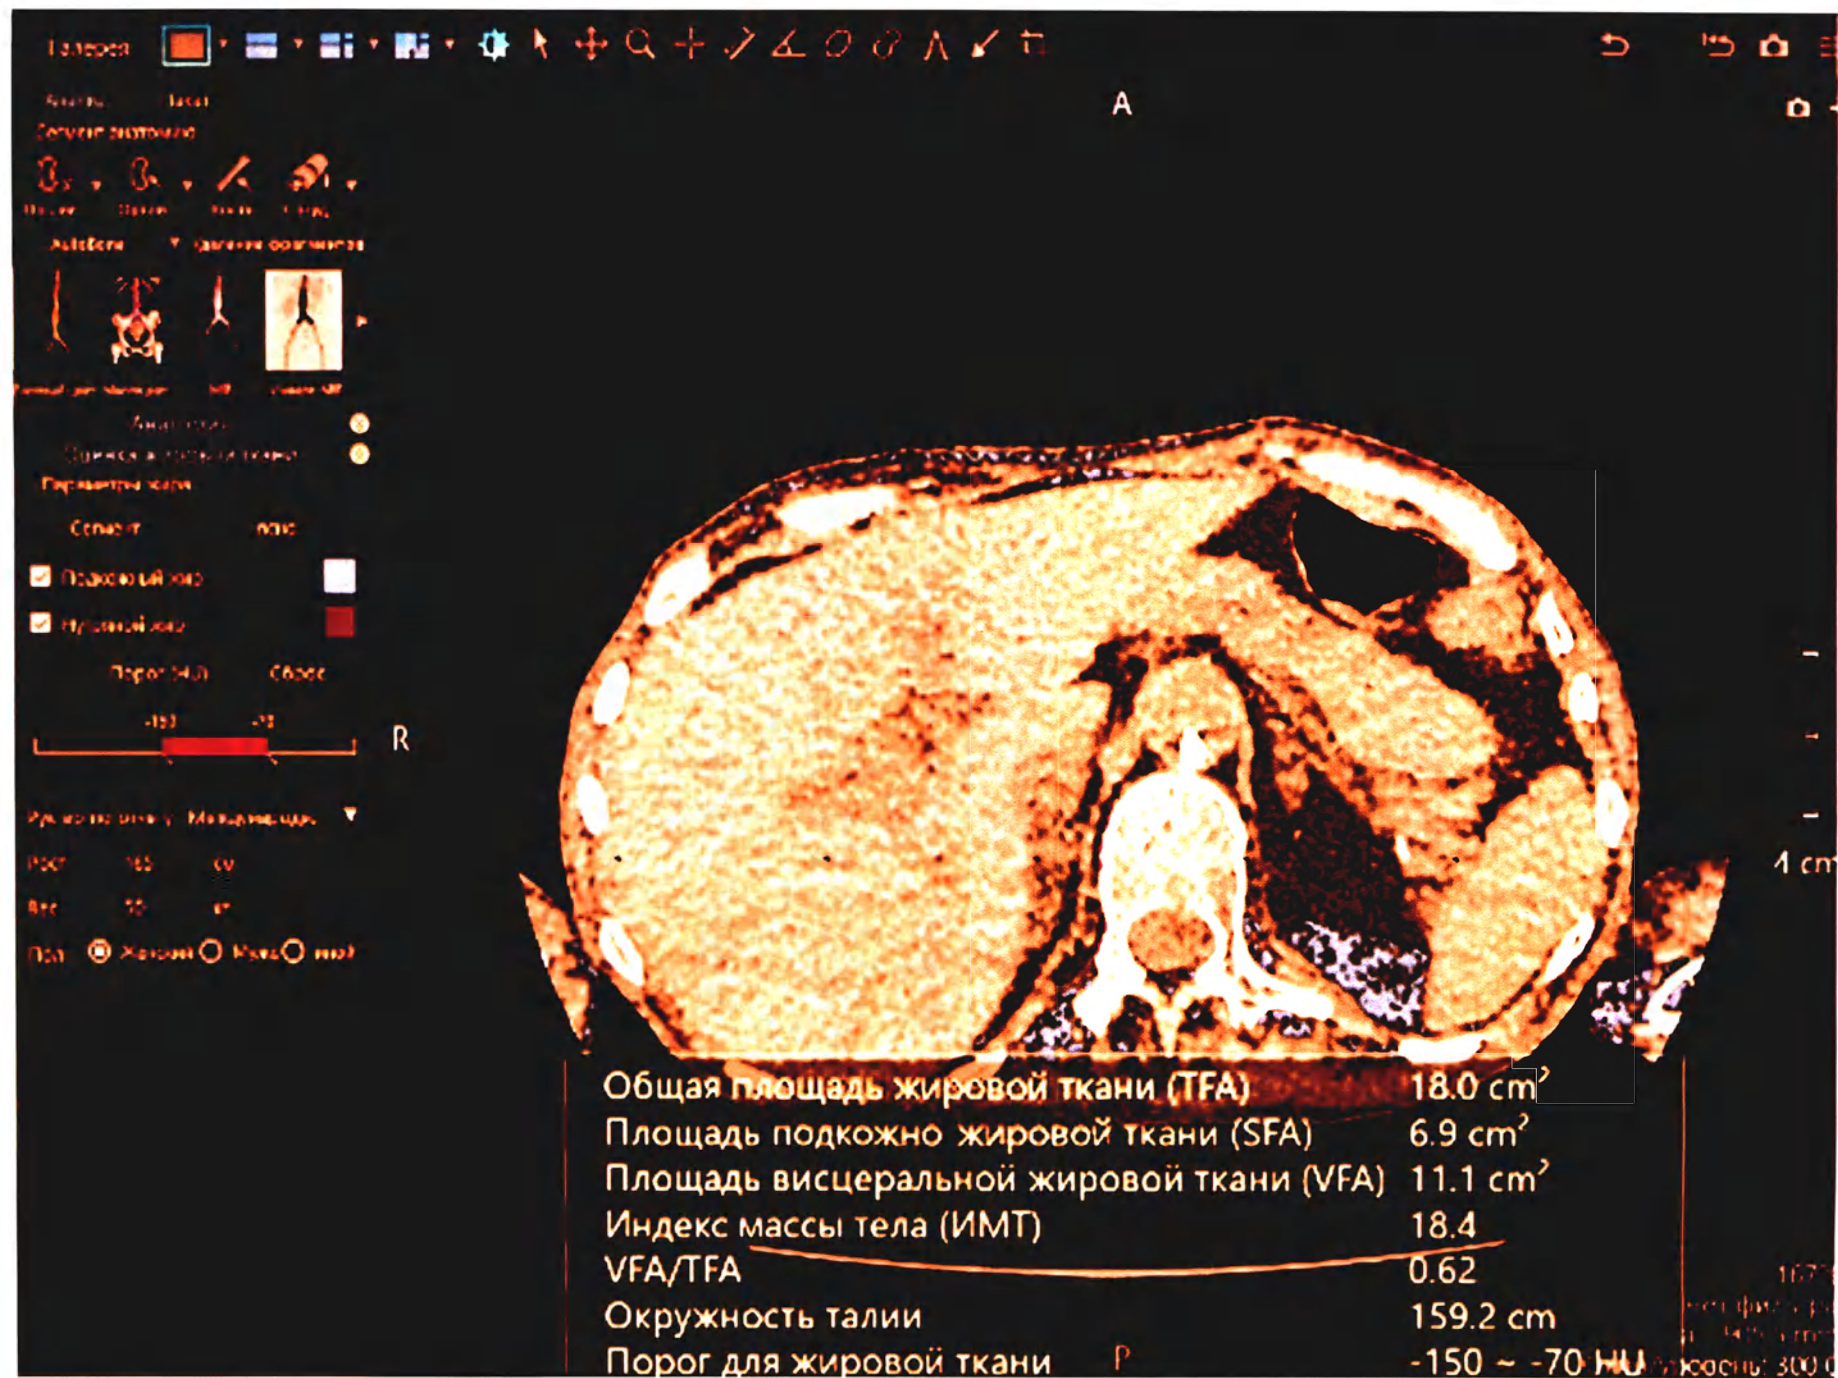


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек)

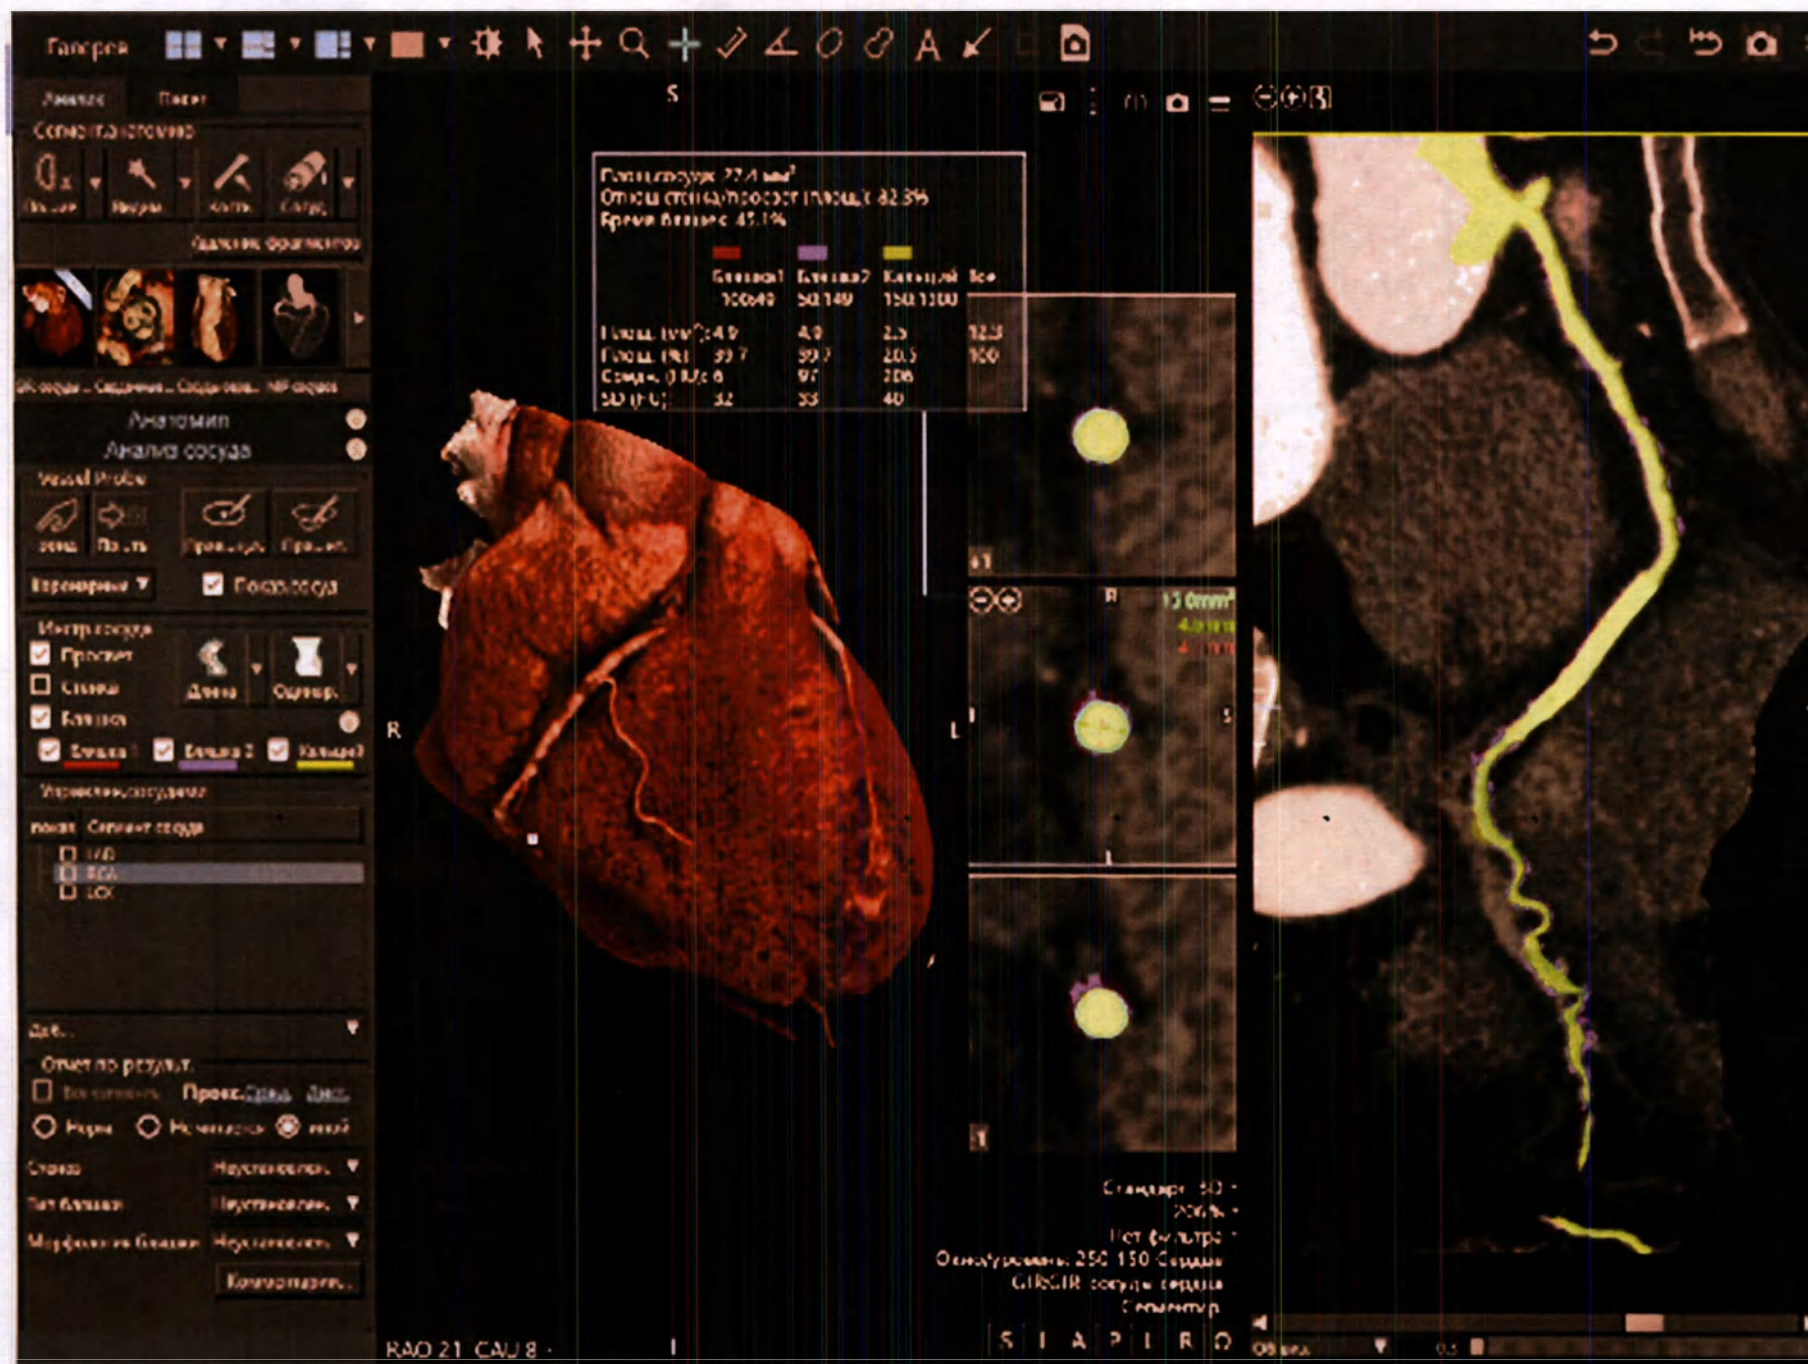


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для оценки перфузии миокарда)

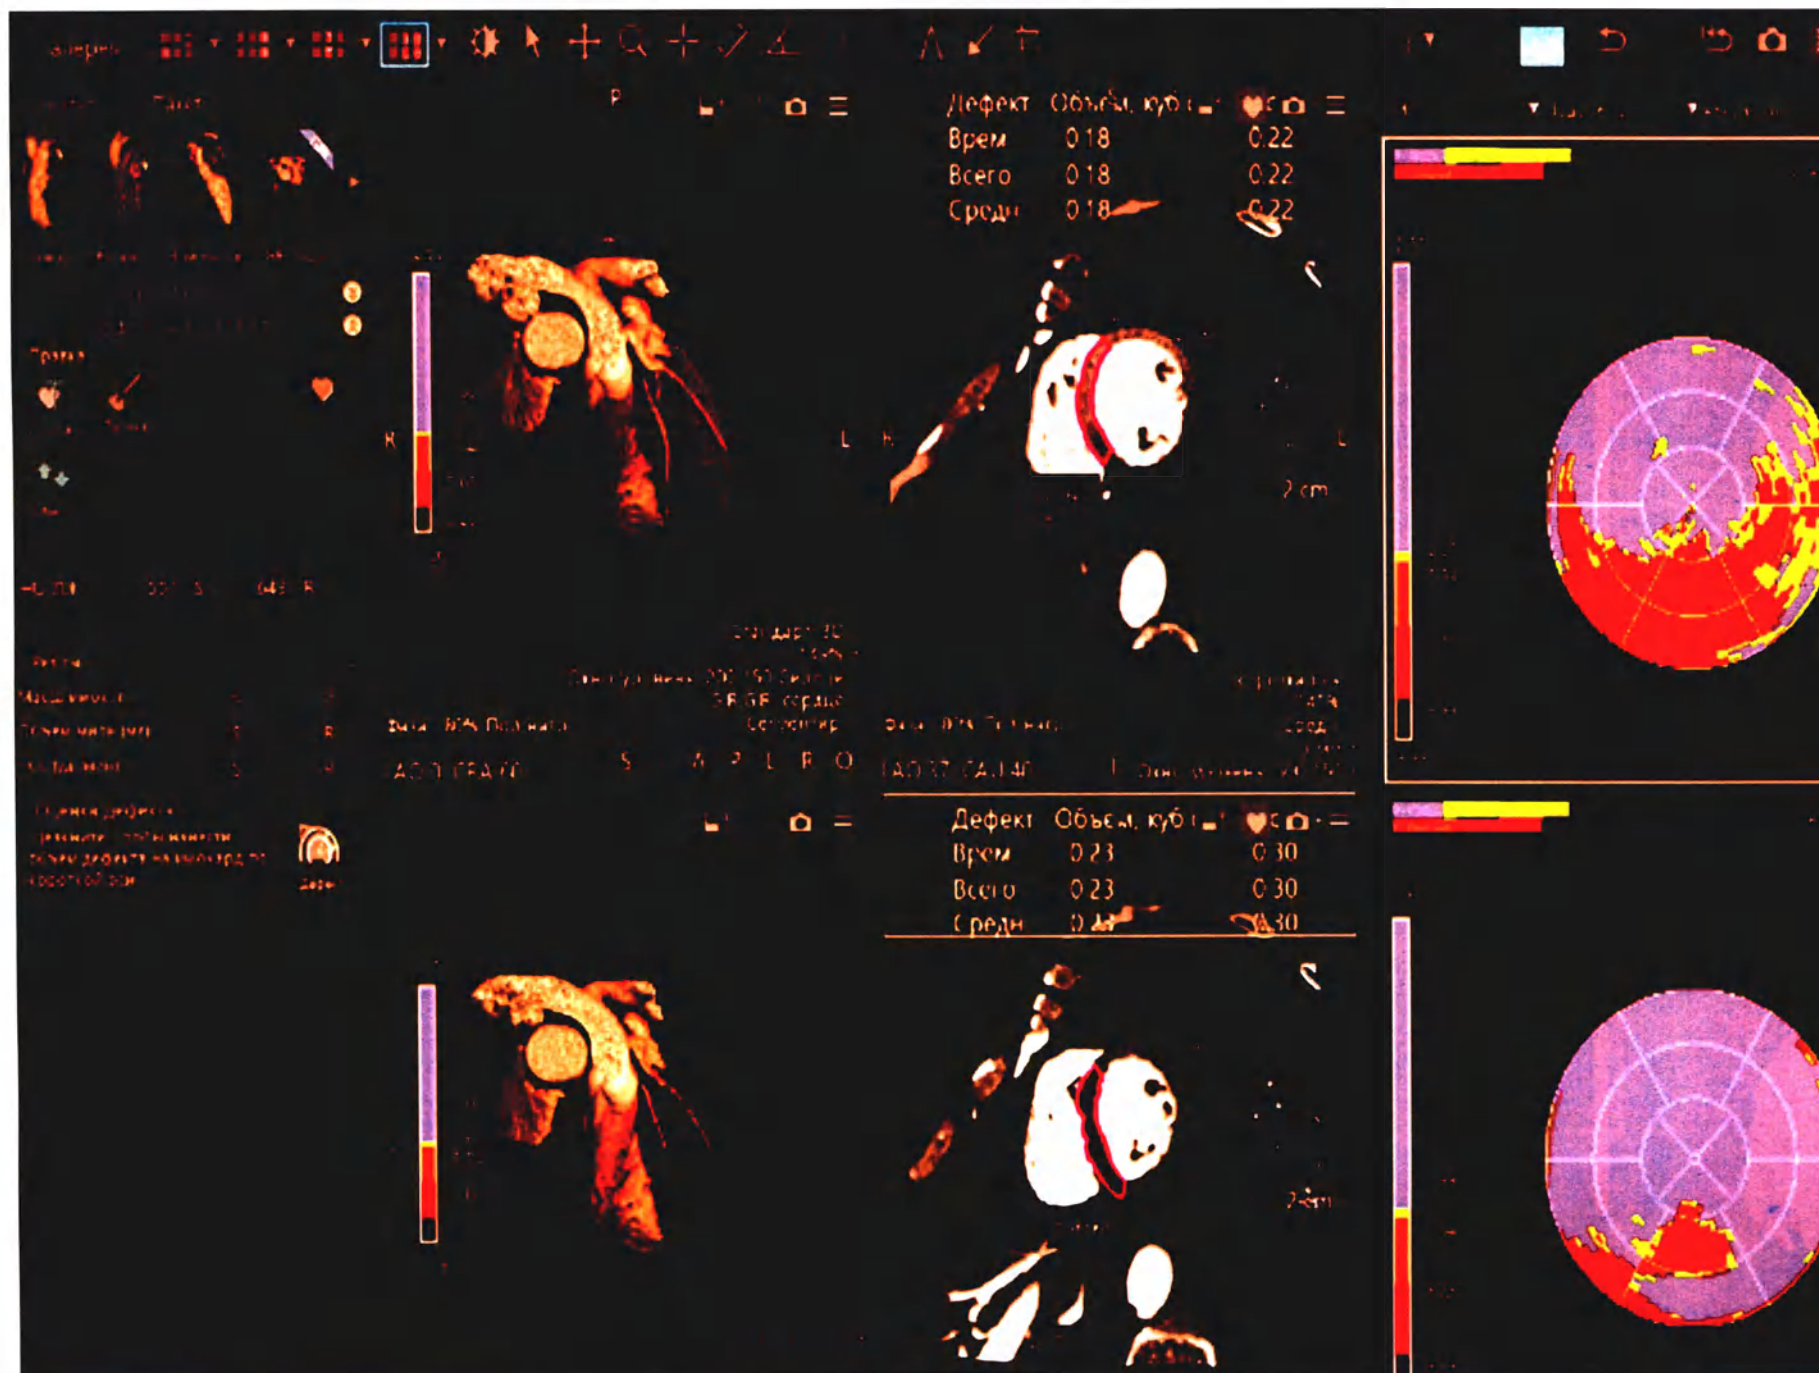

24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для анализа объемных данных перфузии головного мозга)

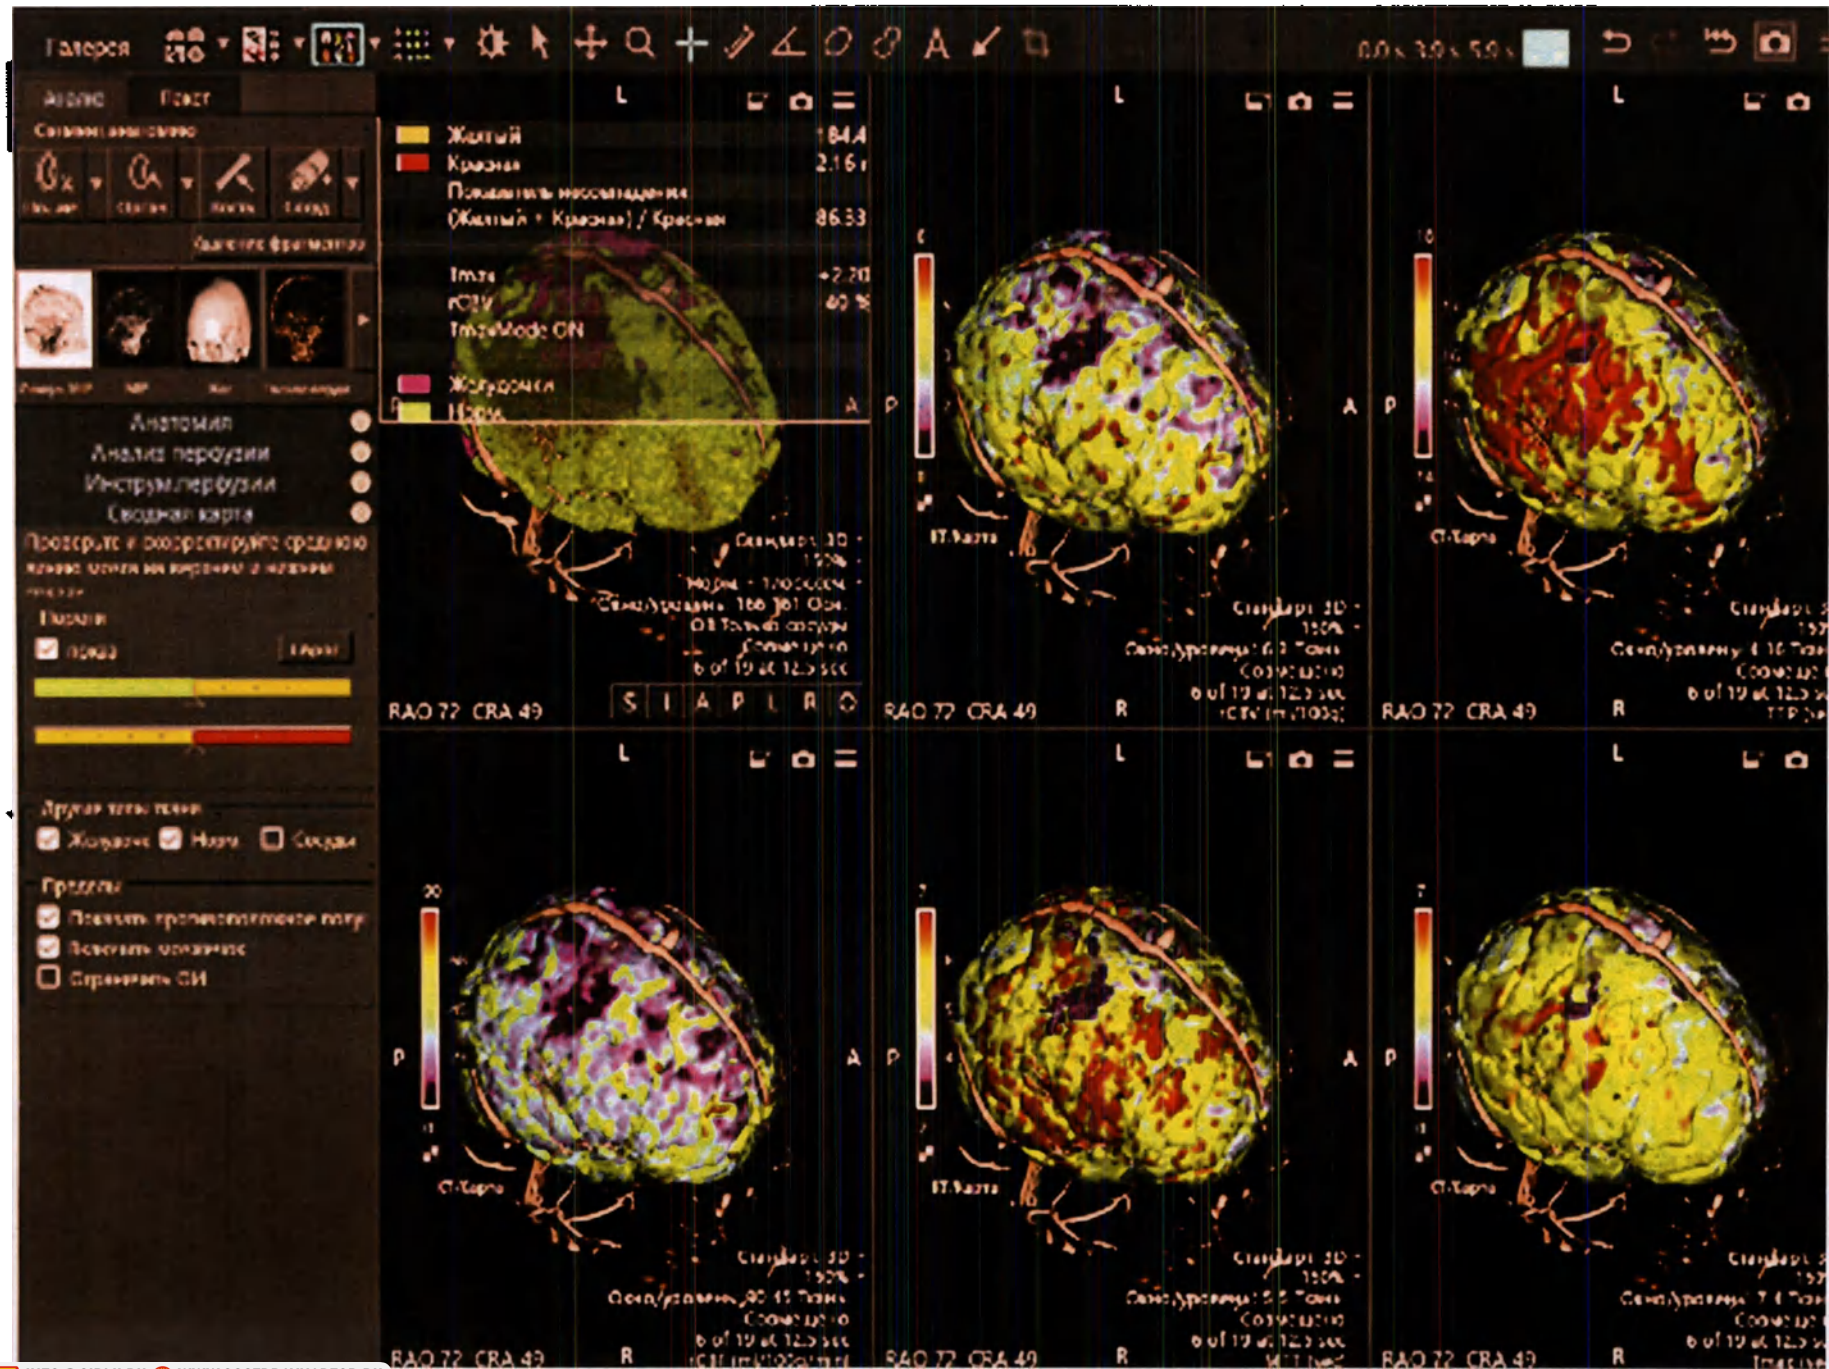


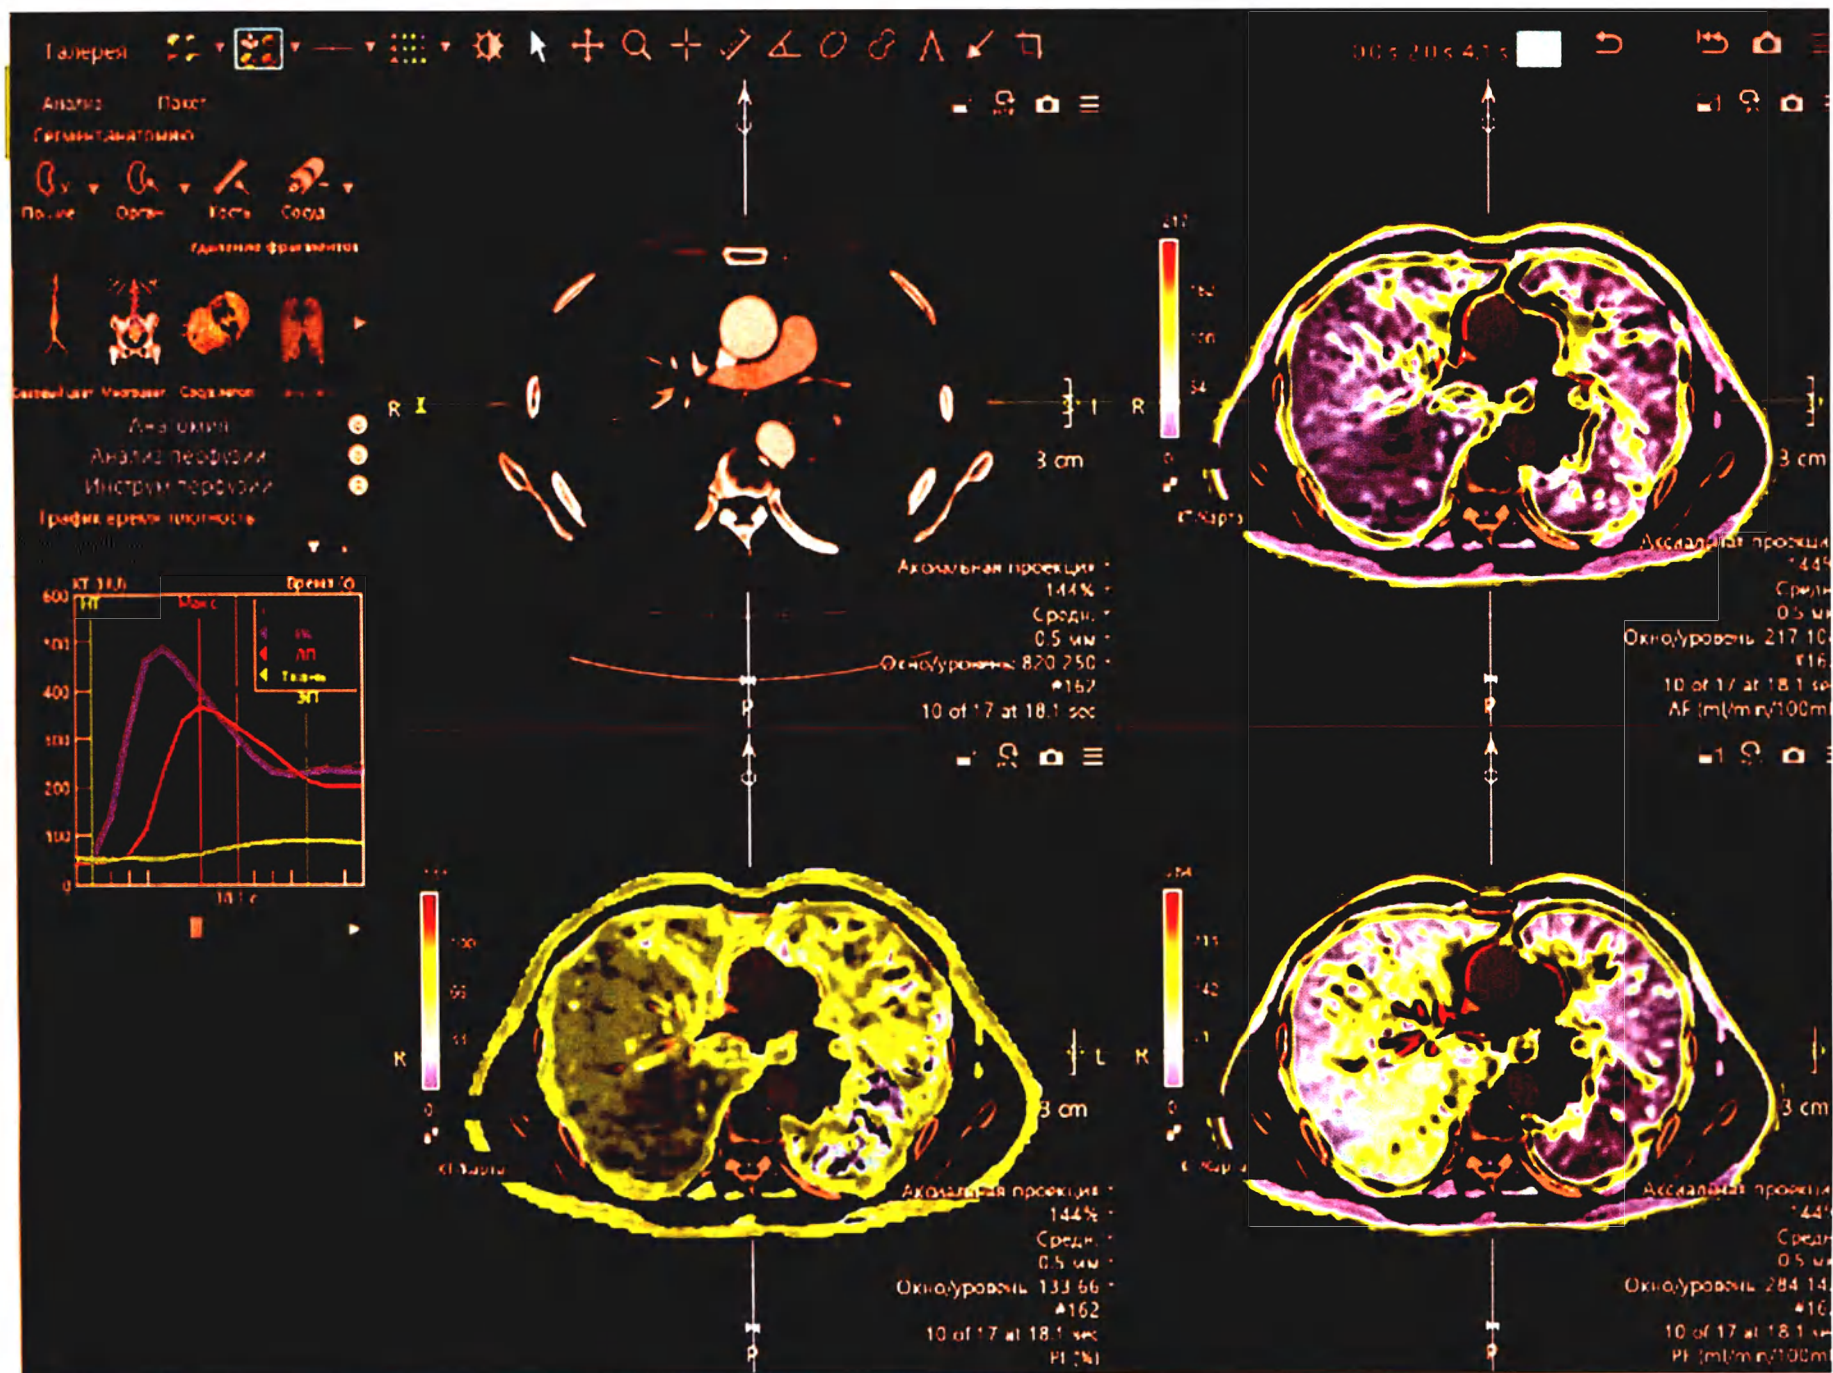


24. Программный пакет Vitrea Revitalize Option Package for CT (при необходимости) (Приложение для улучшения качества изображений)




25. Приложение для электрофизиологического планирования (при необходимости)

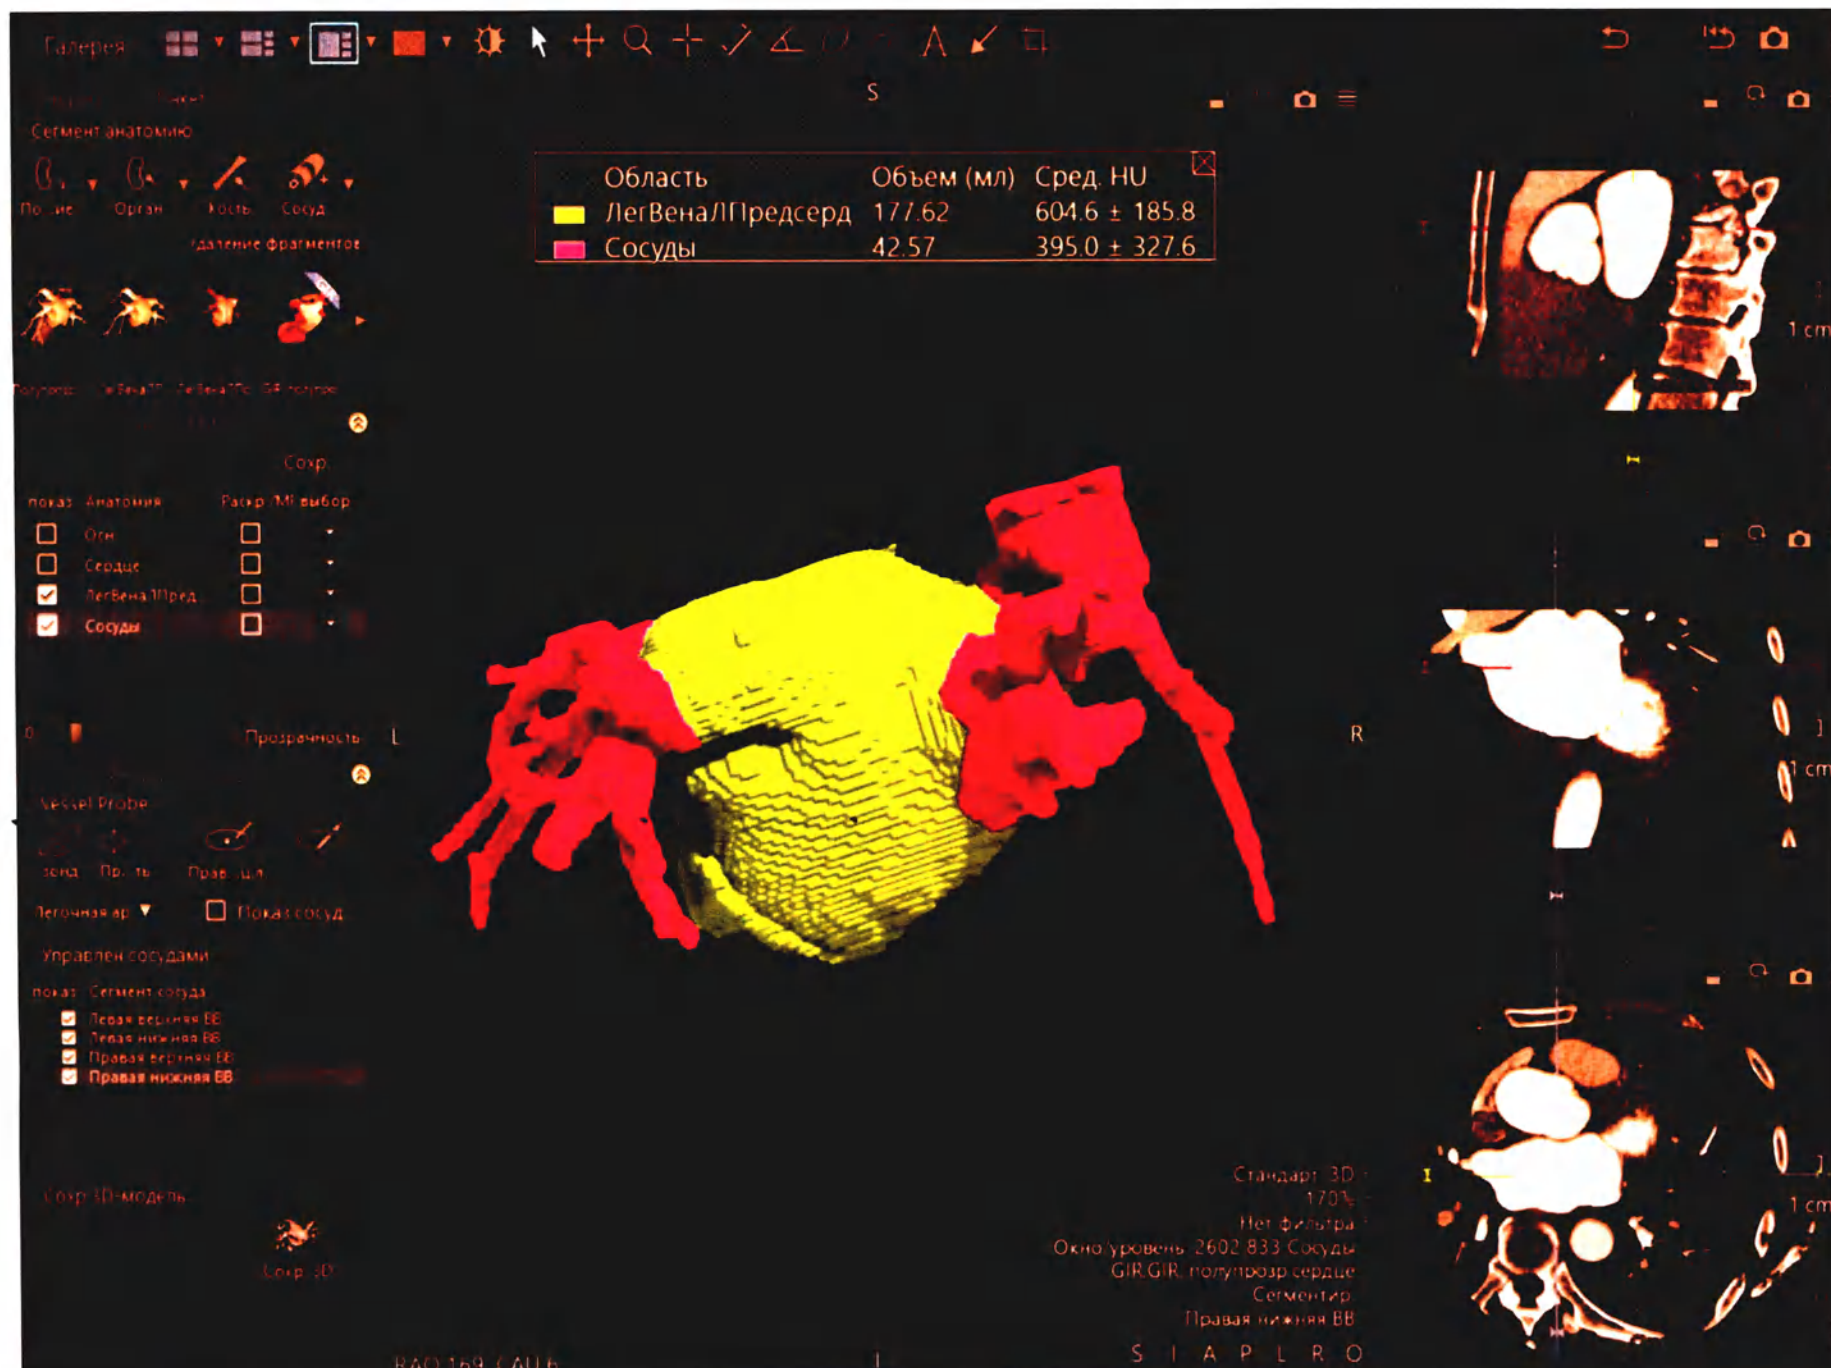


26. Приложение для планирования установки стента (при необходимости)

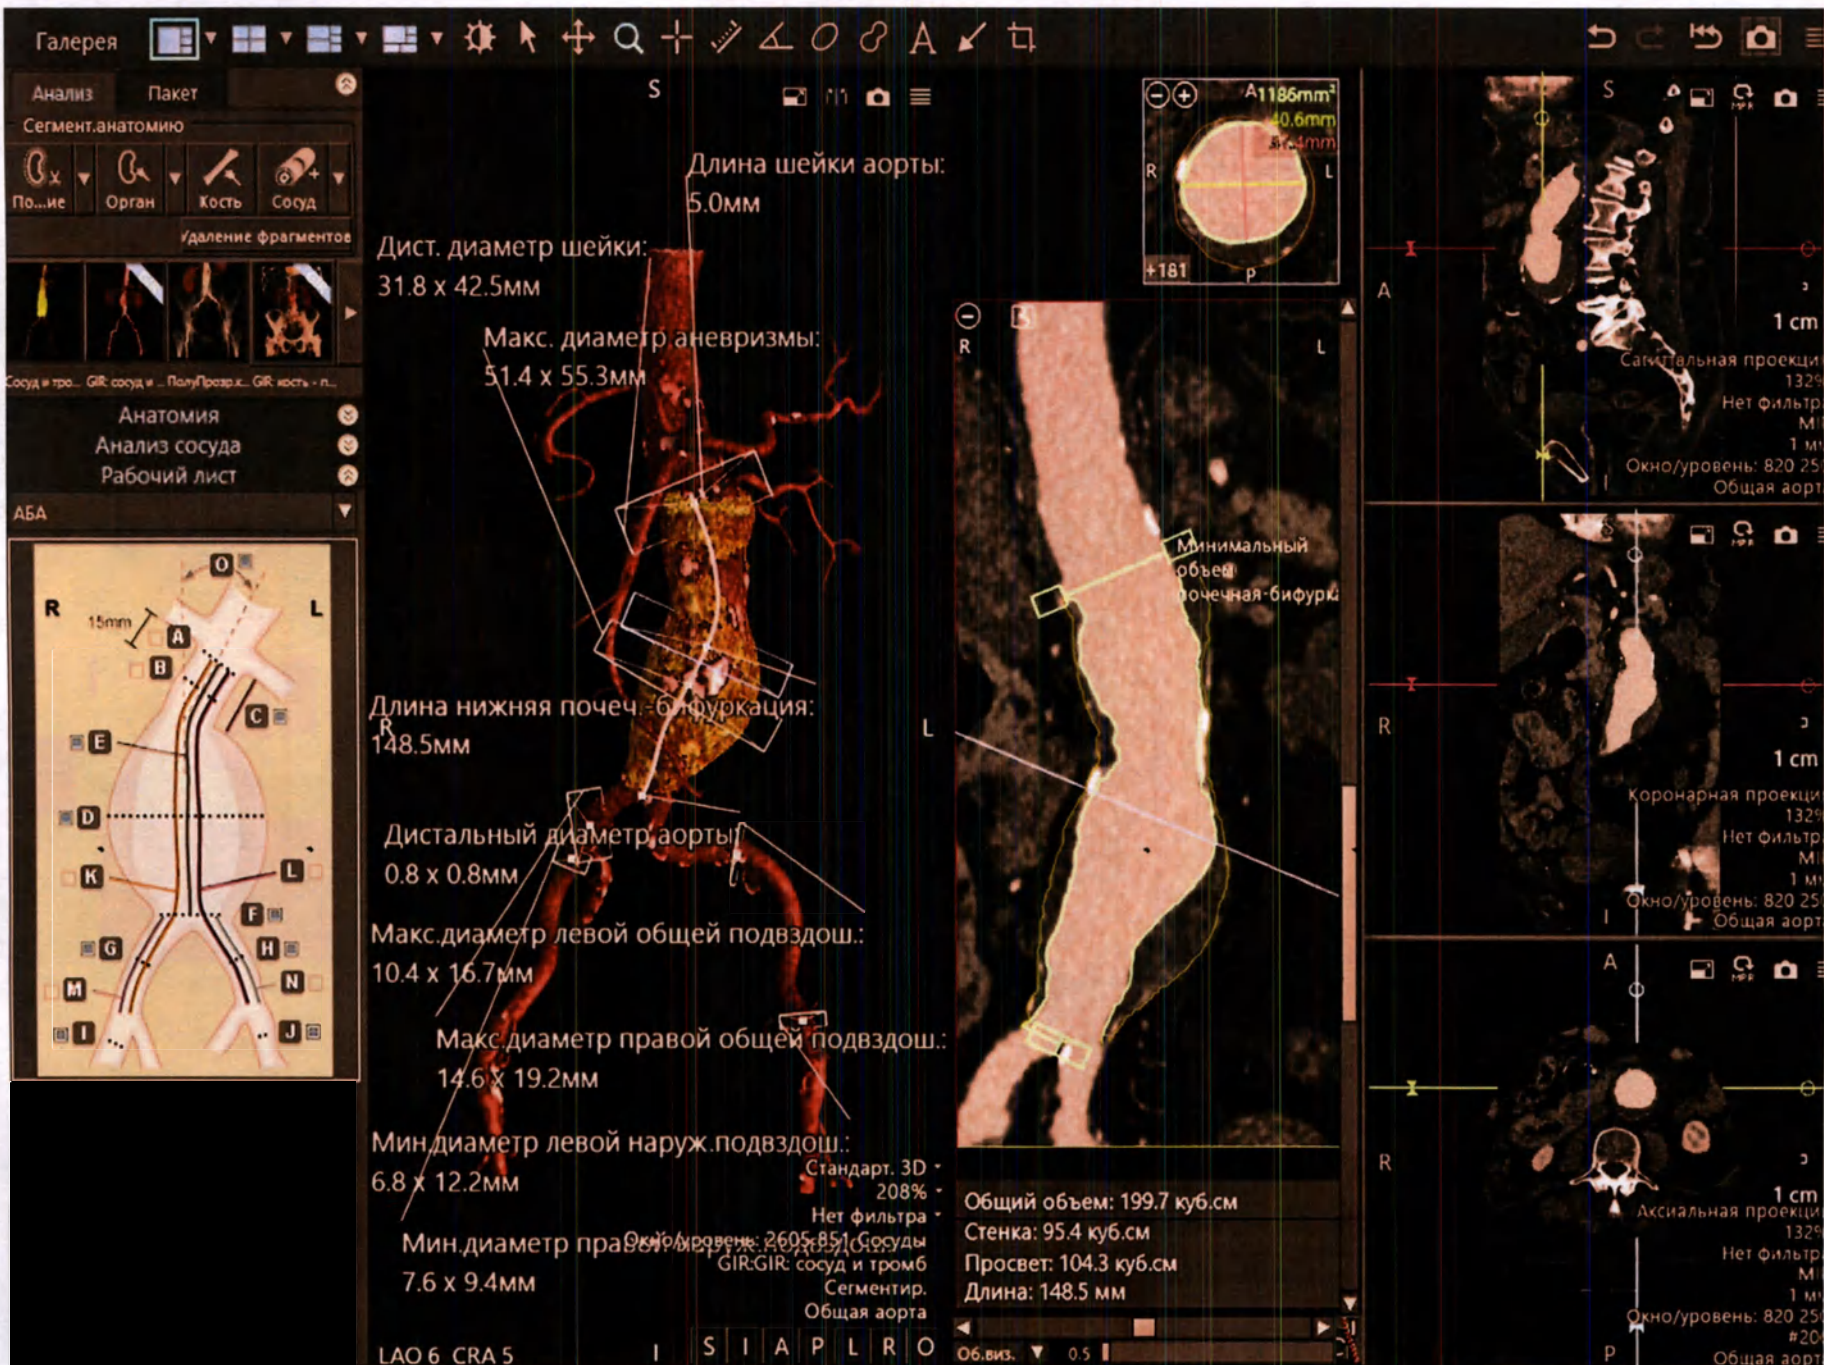


27. Приложение для анализа печени (при необходимости)

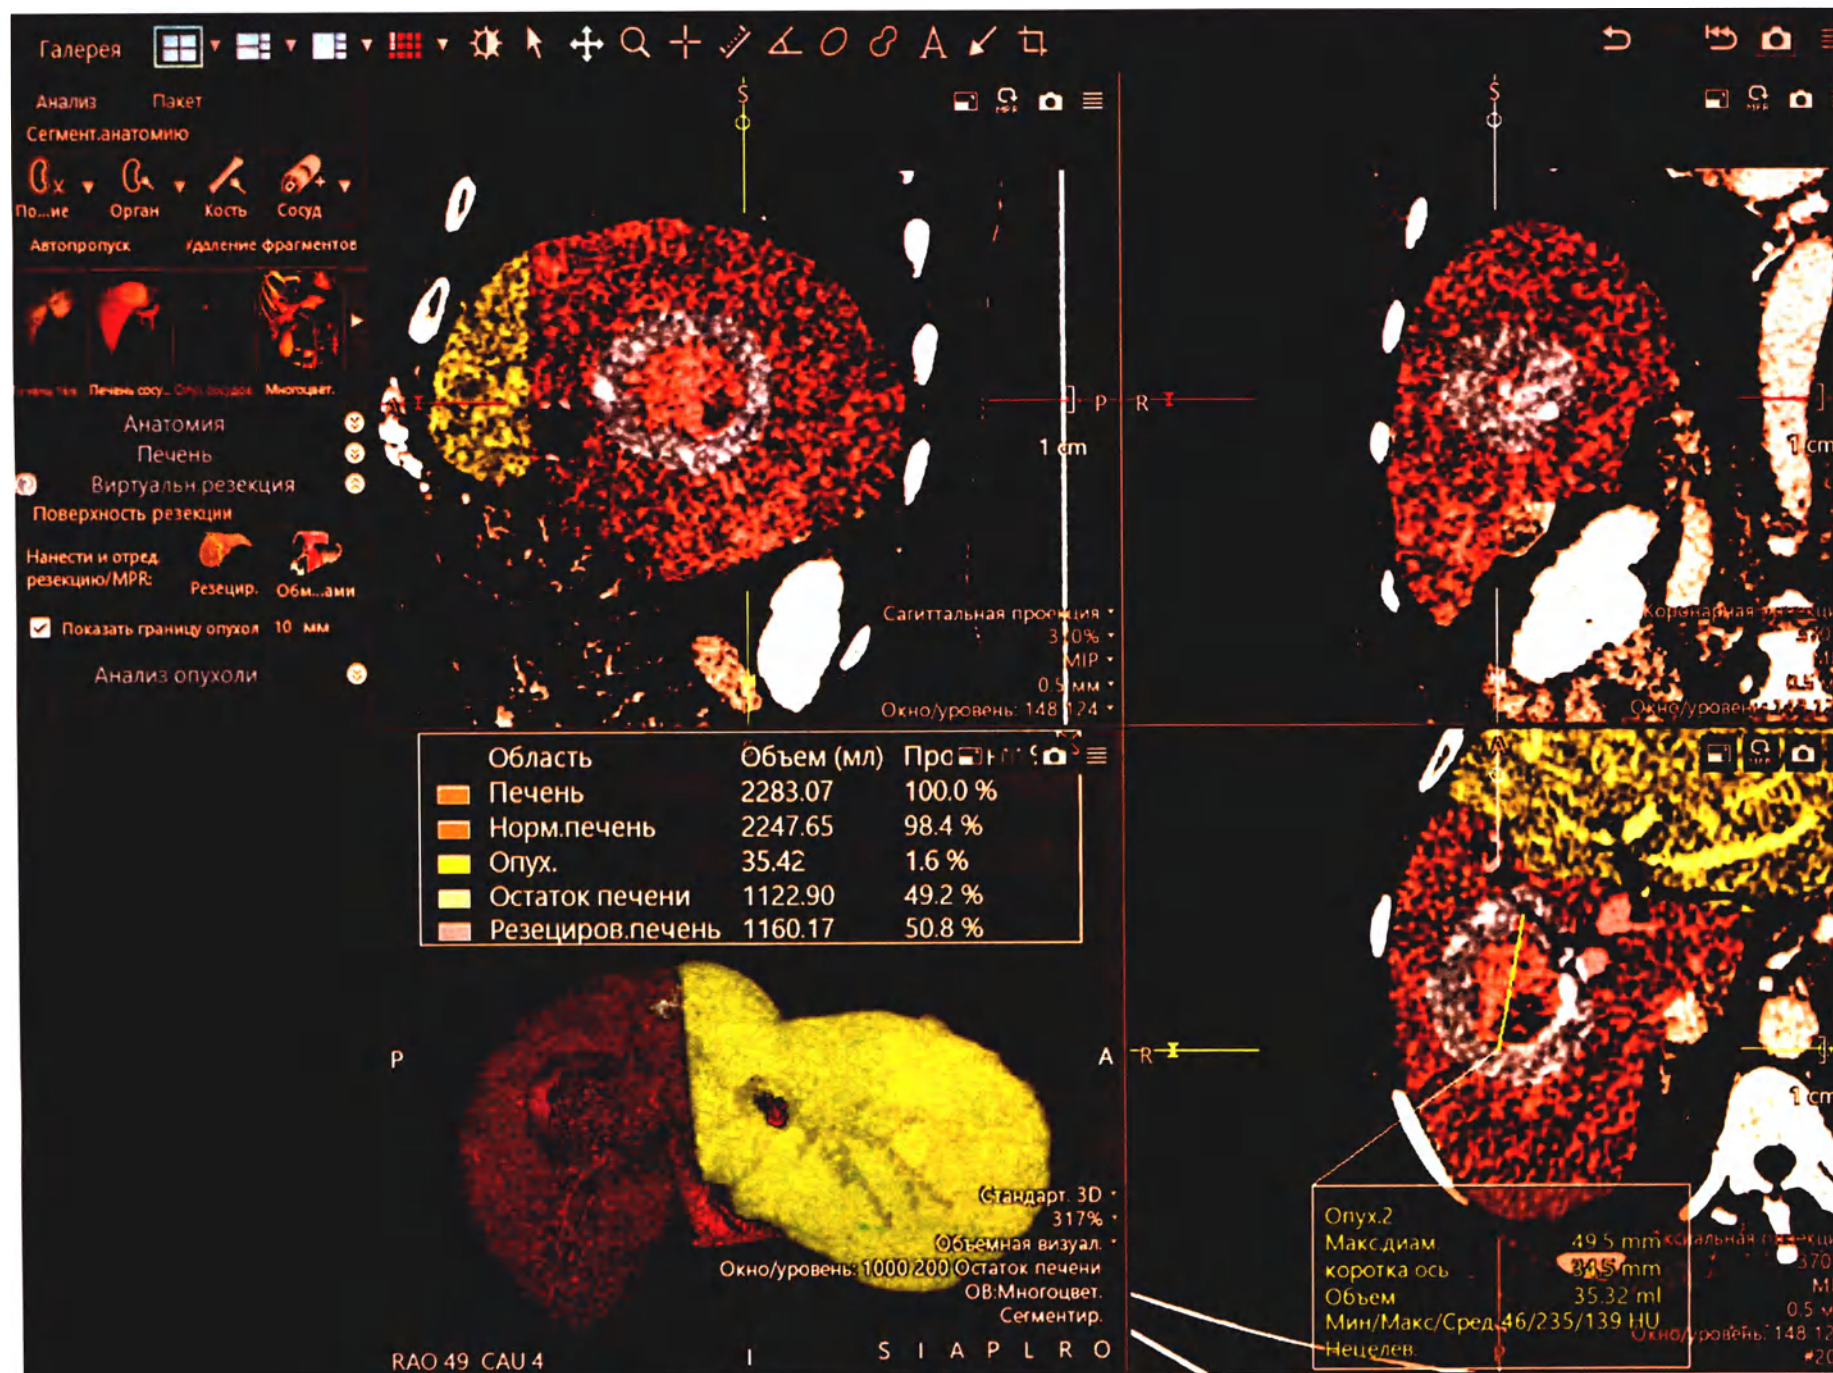

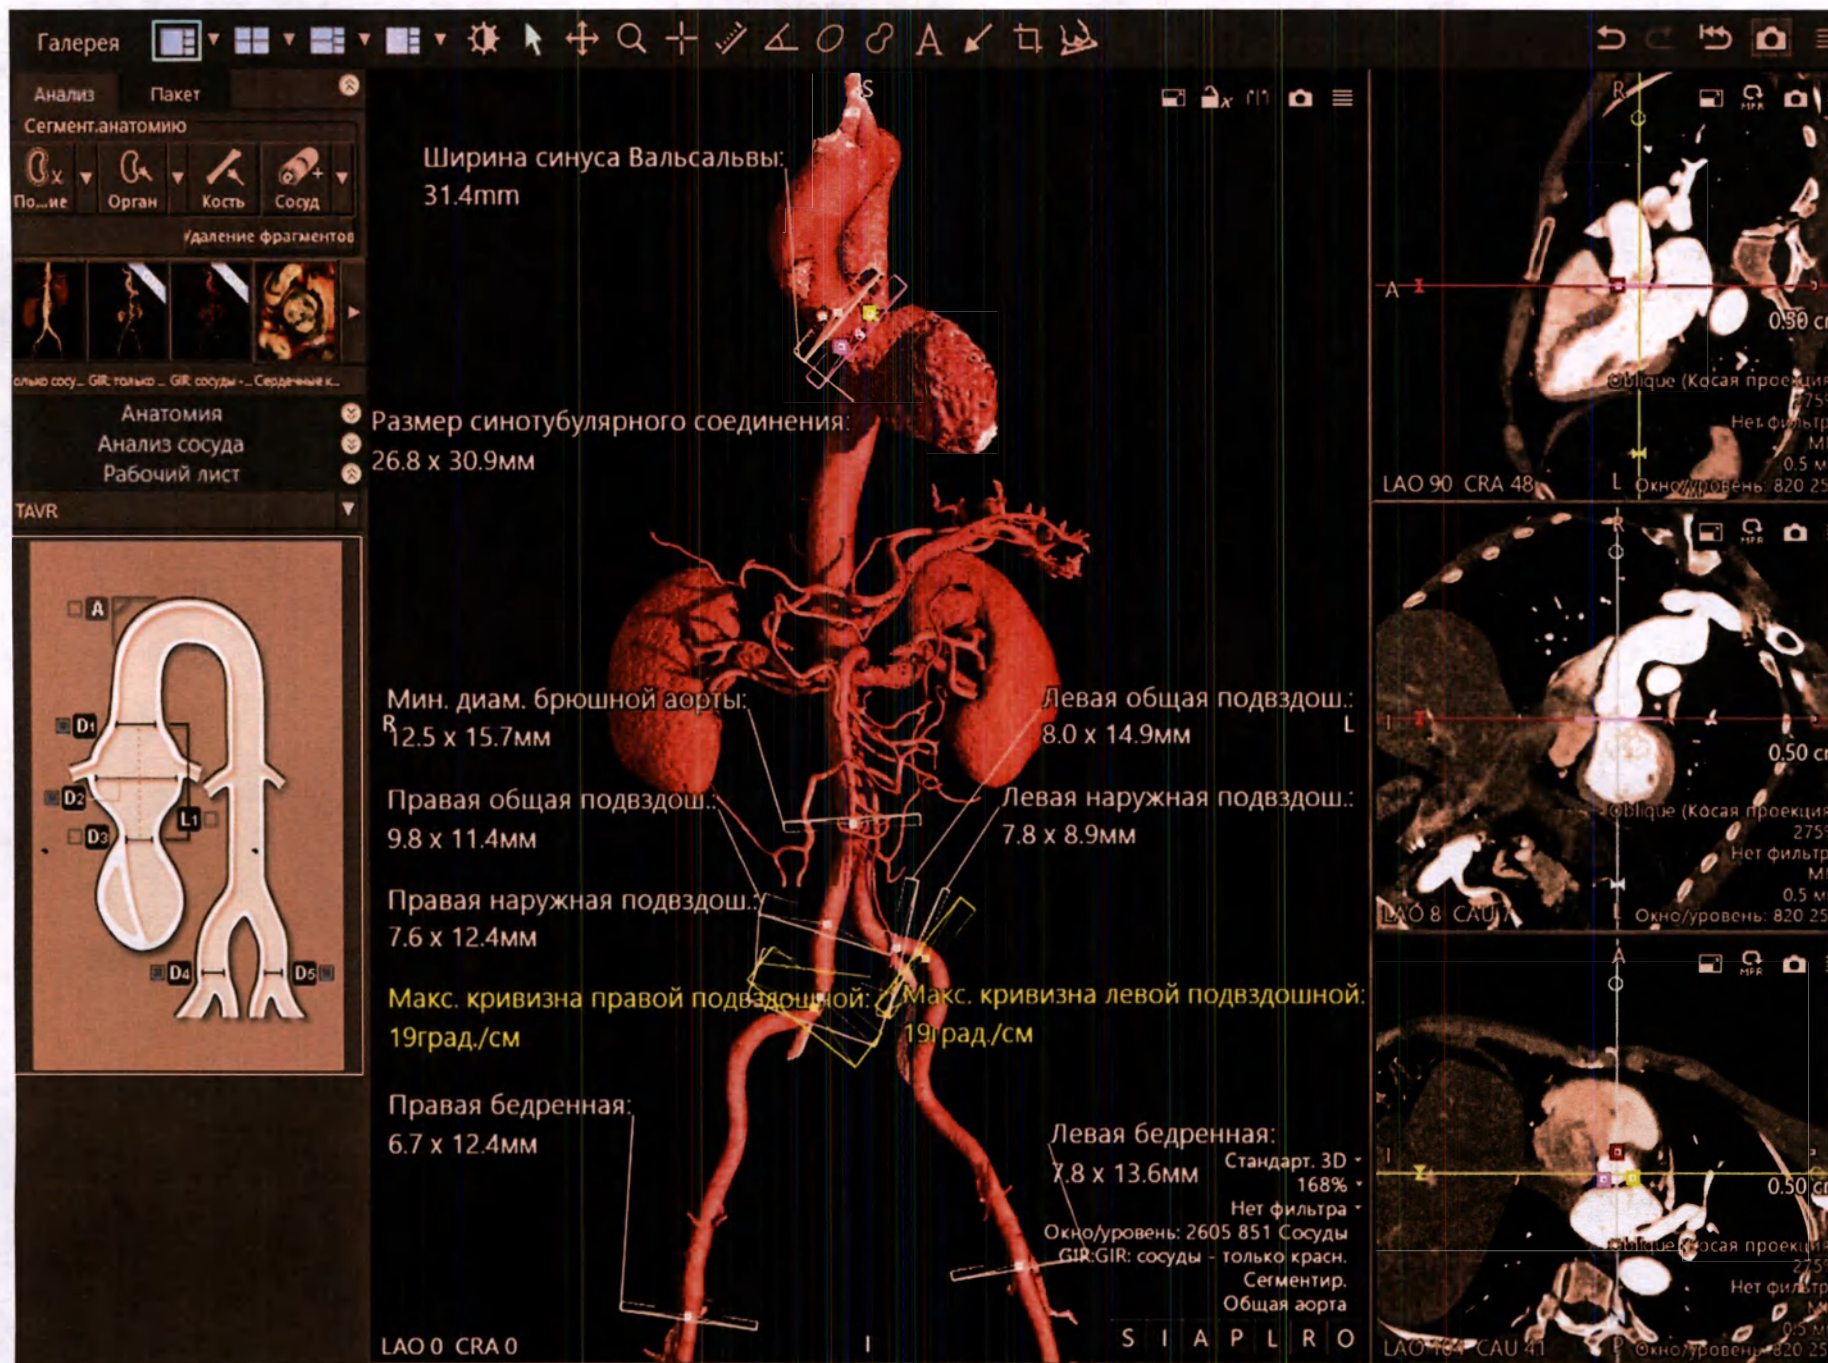


29. Приложение для виртуальной колоноскопии (при необходимости)

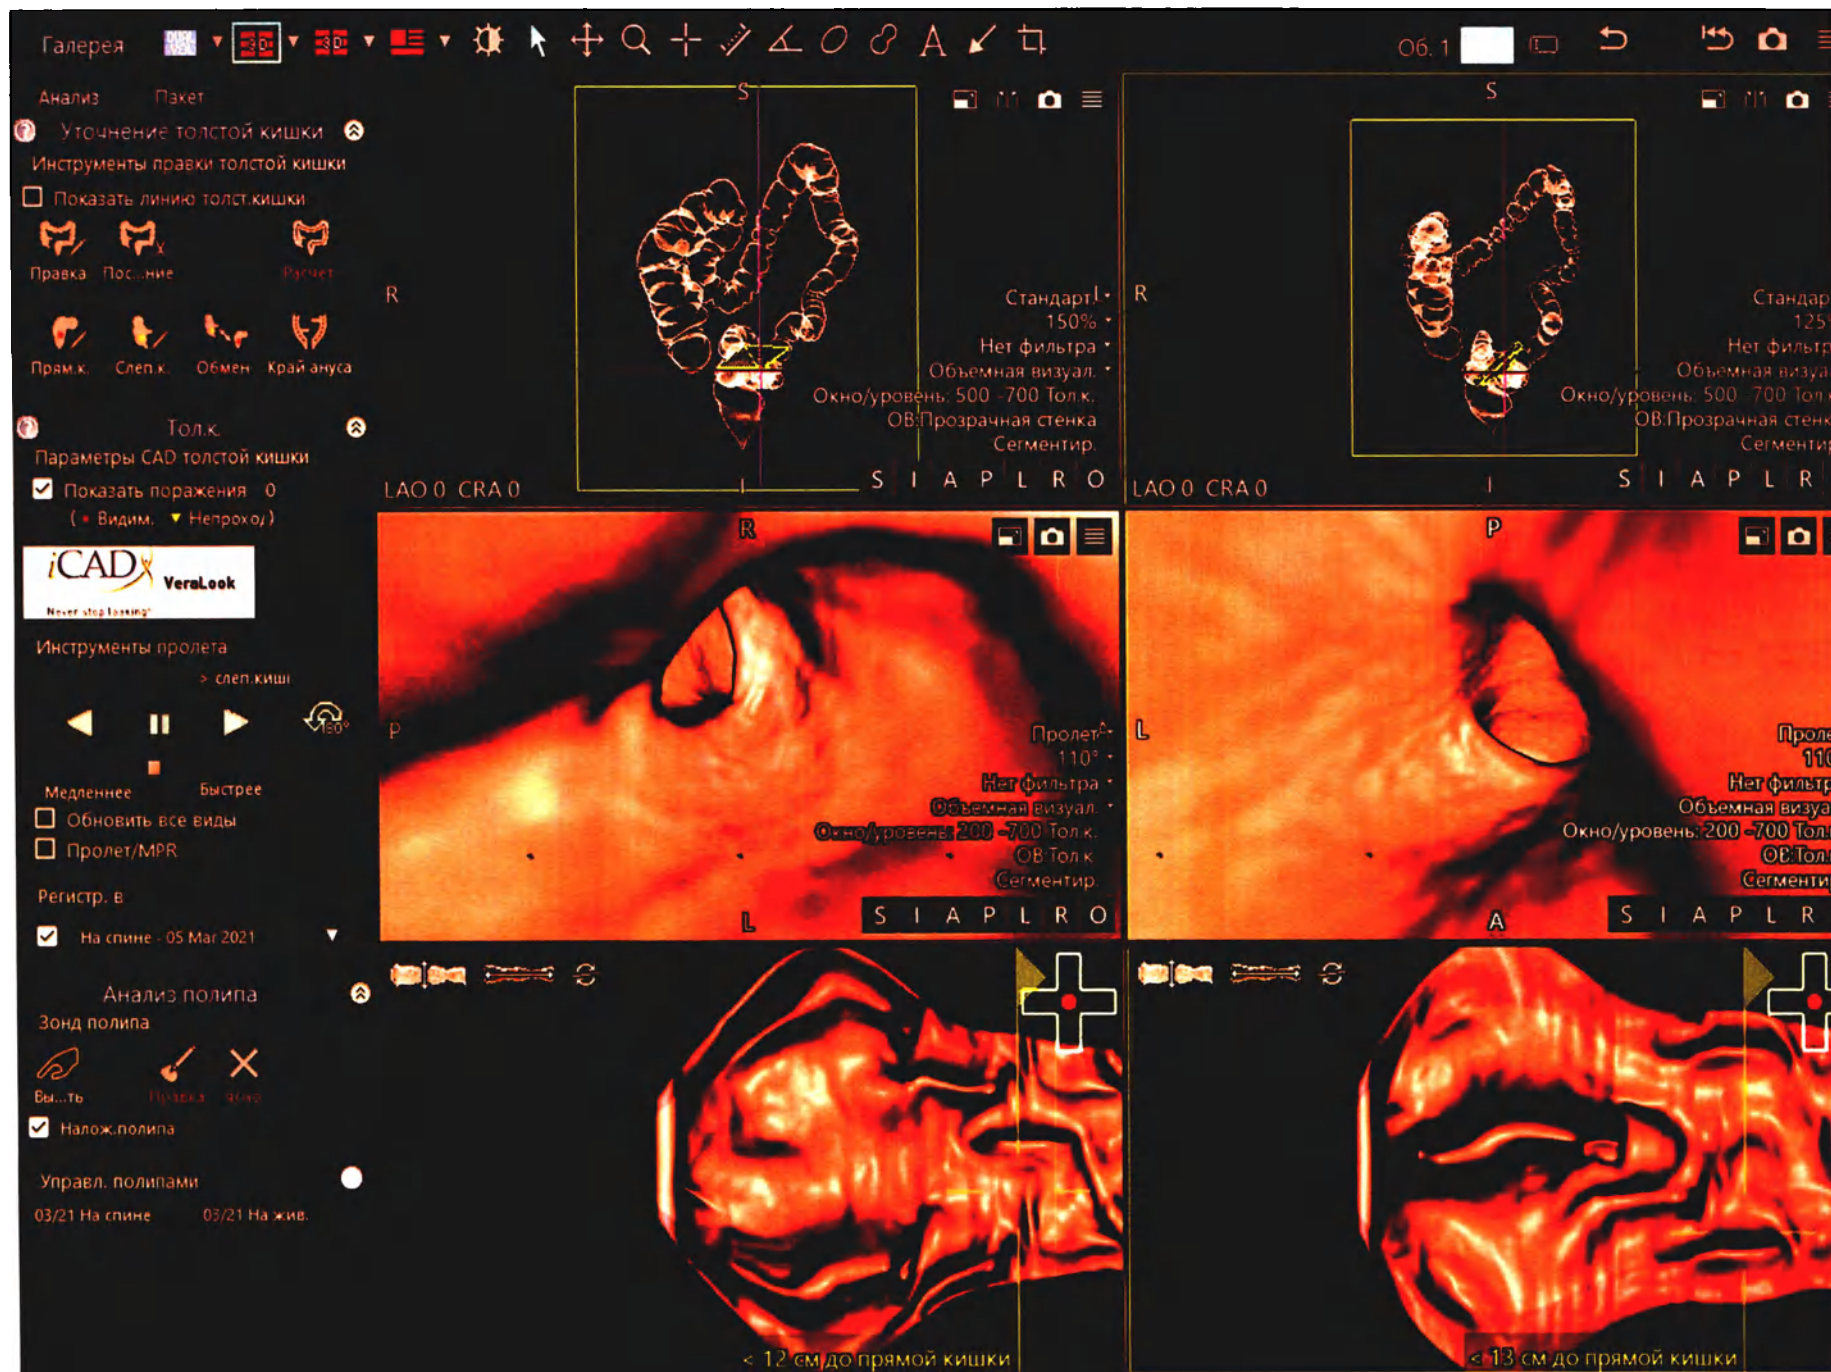


30. Приложение для анализа узелковых образований легких (при необходимости)




31. Приложение для анализа плотности легочной ткани (при необходимости)

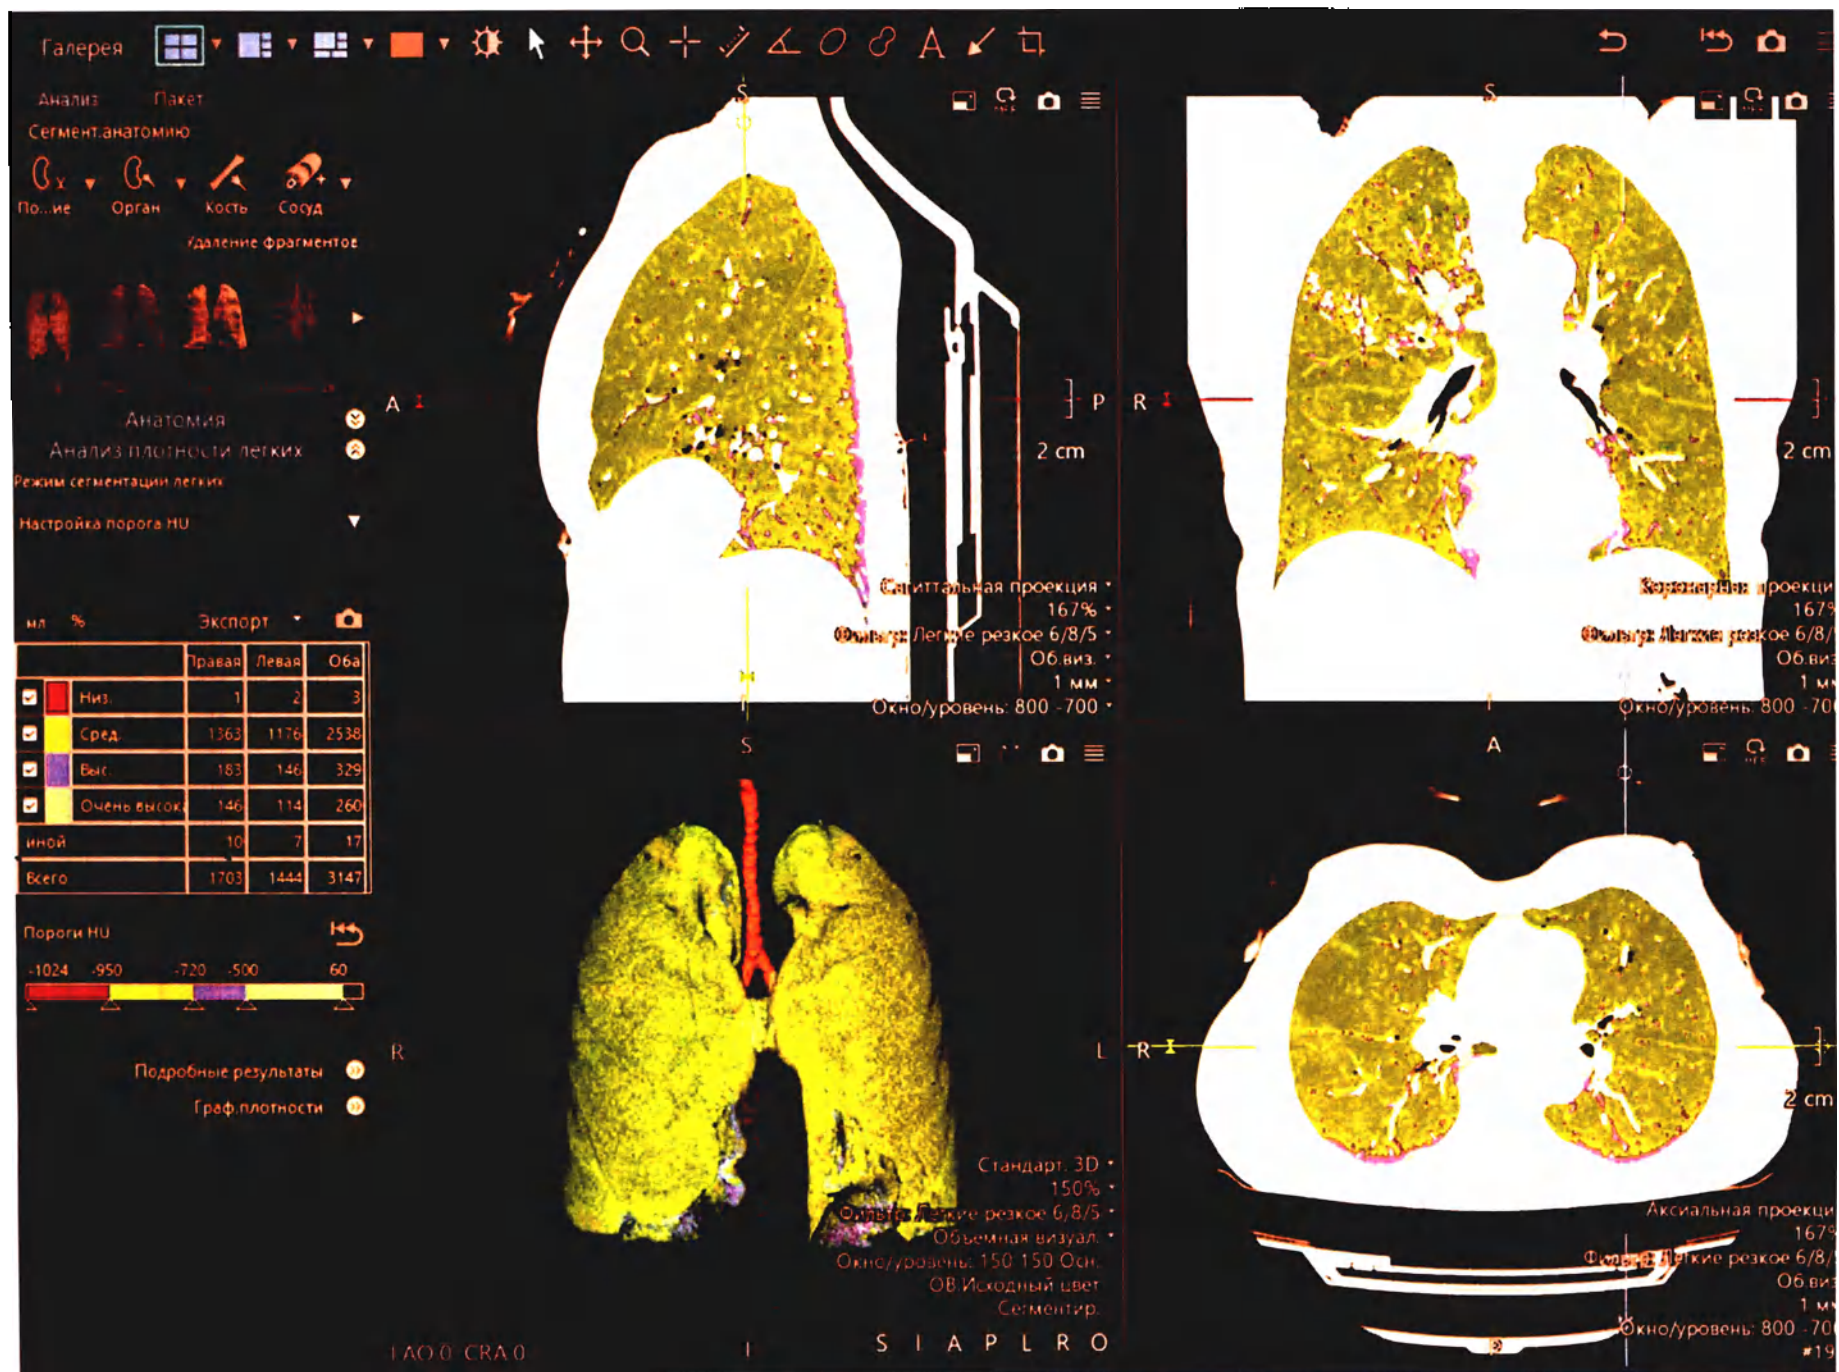


32. Приложение для анализа перфузии головного мозга (при необходимости)

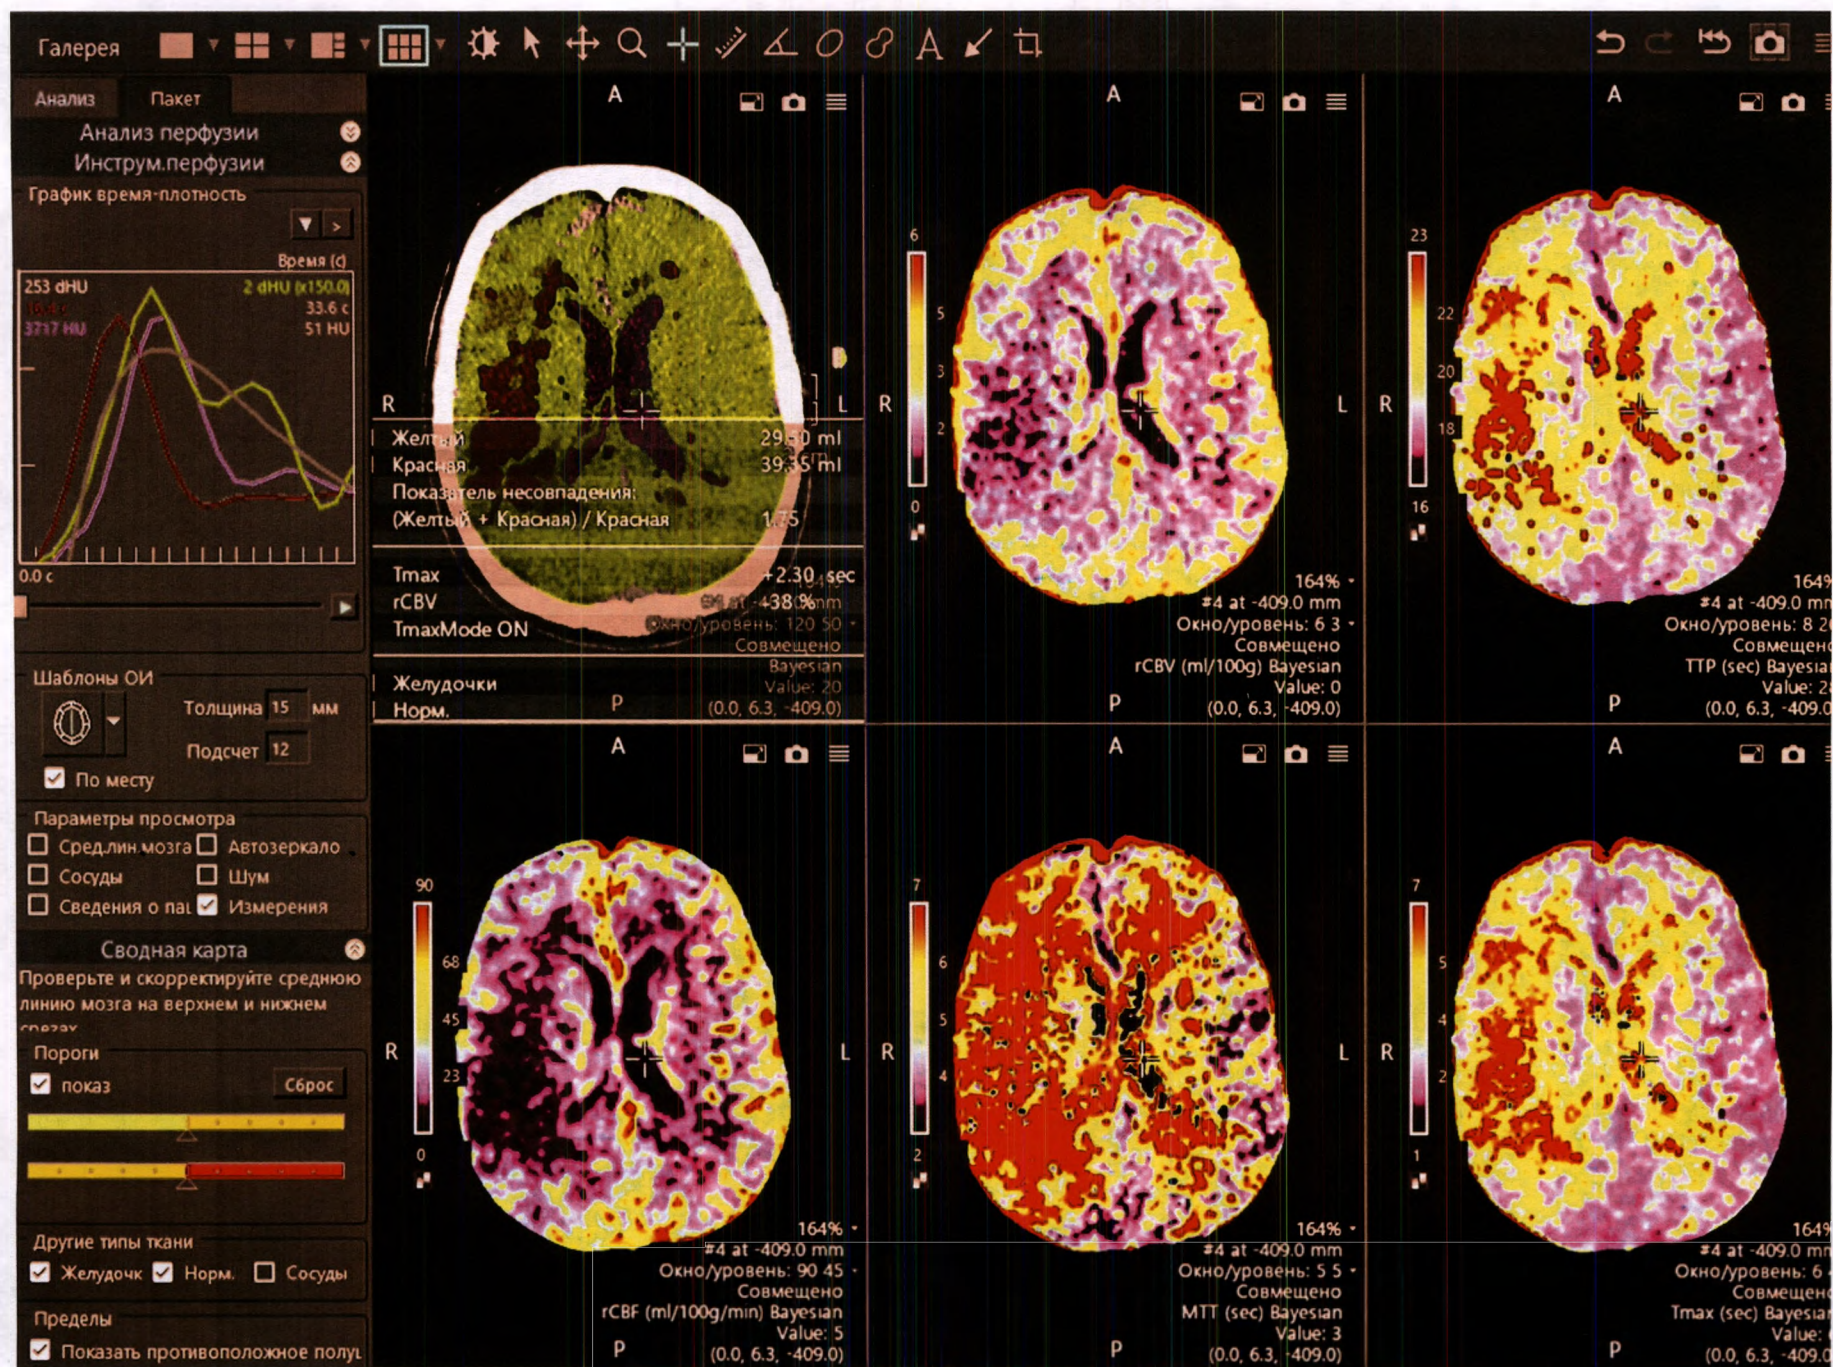


33. Приложение для оценки содержания кальция (при необходимости)

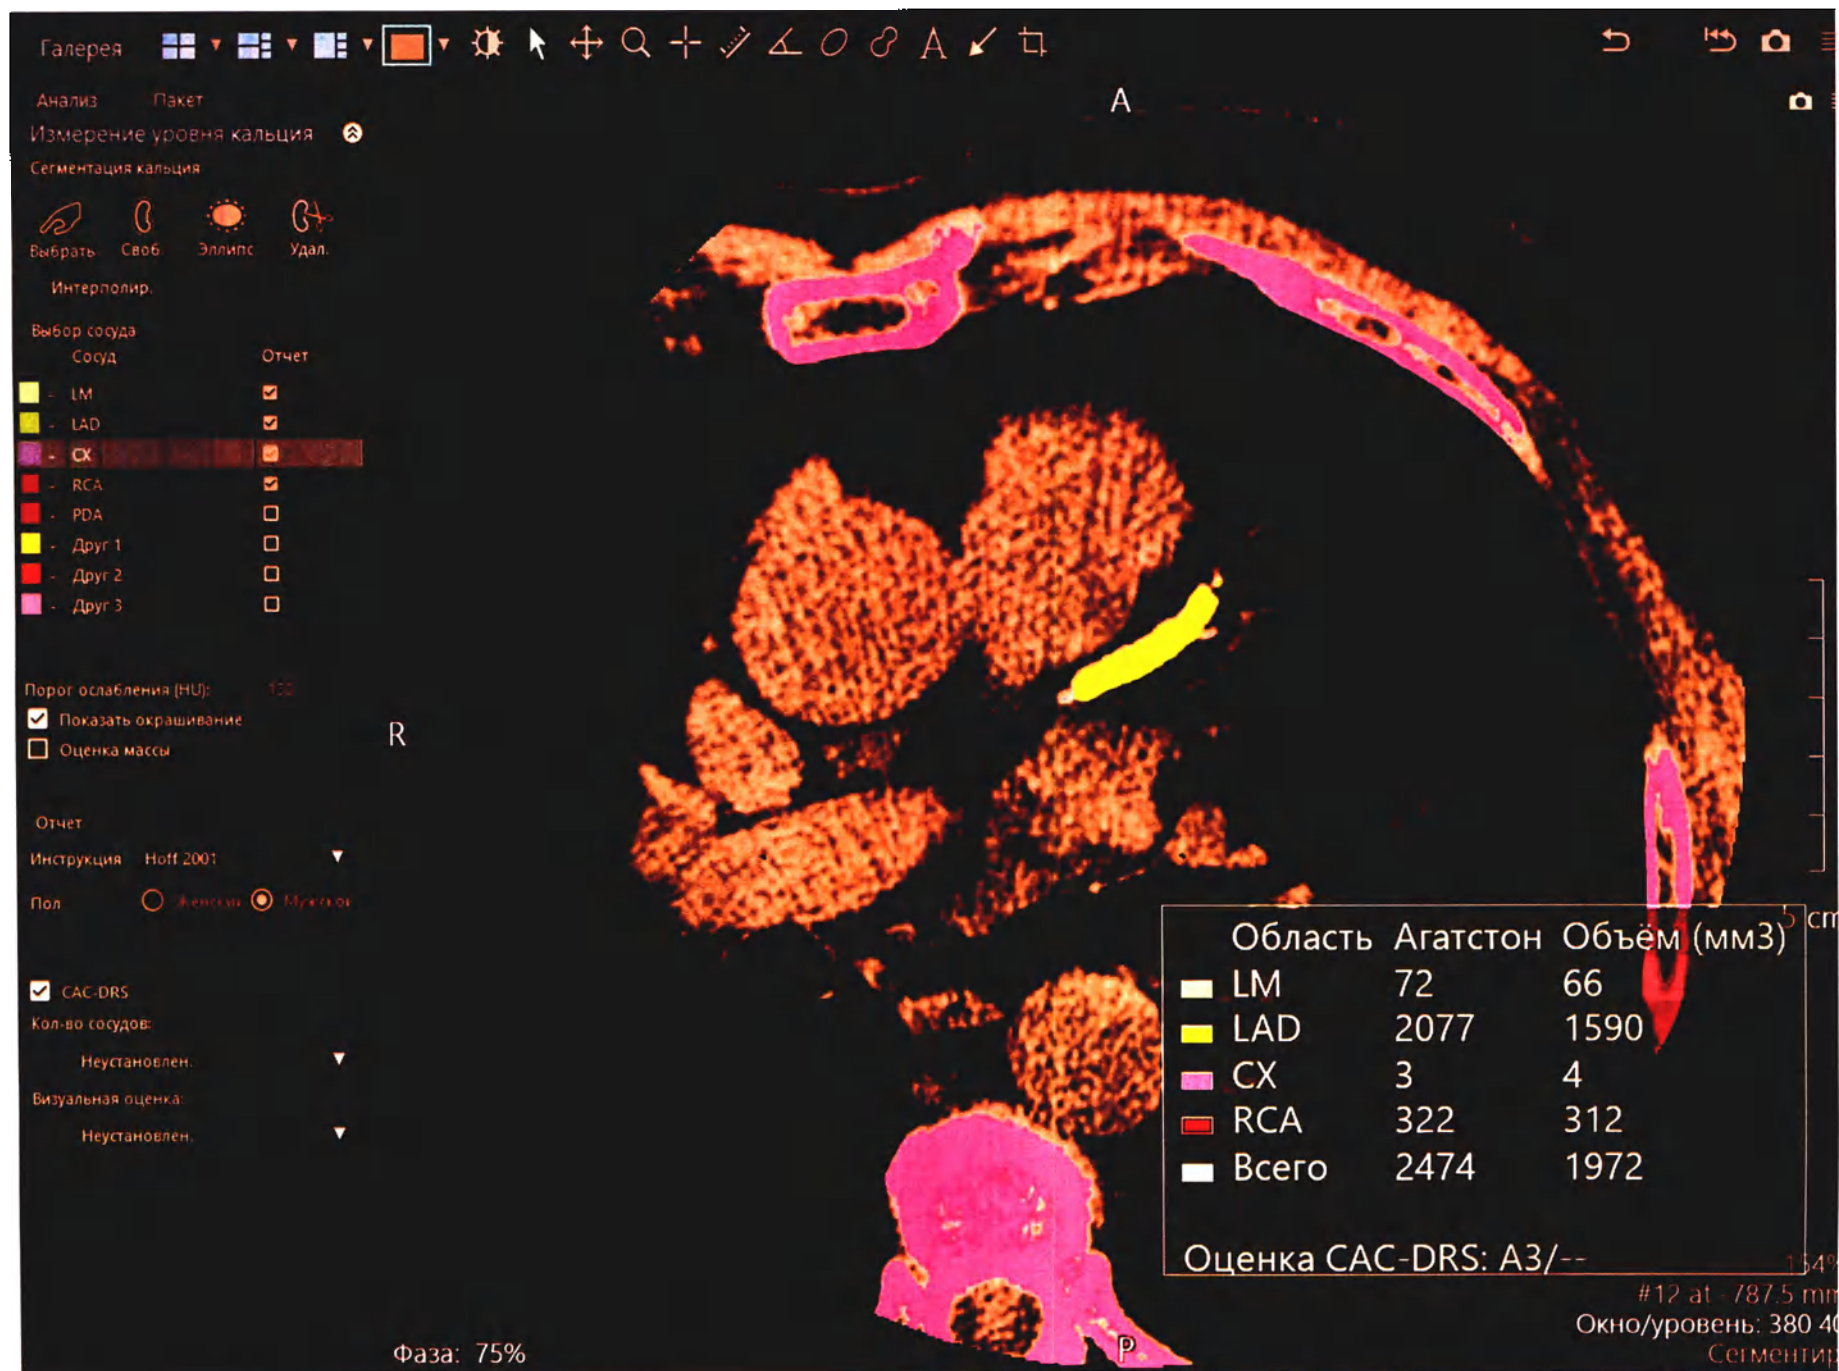


34. Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов (при необходимости)

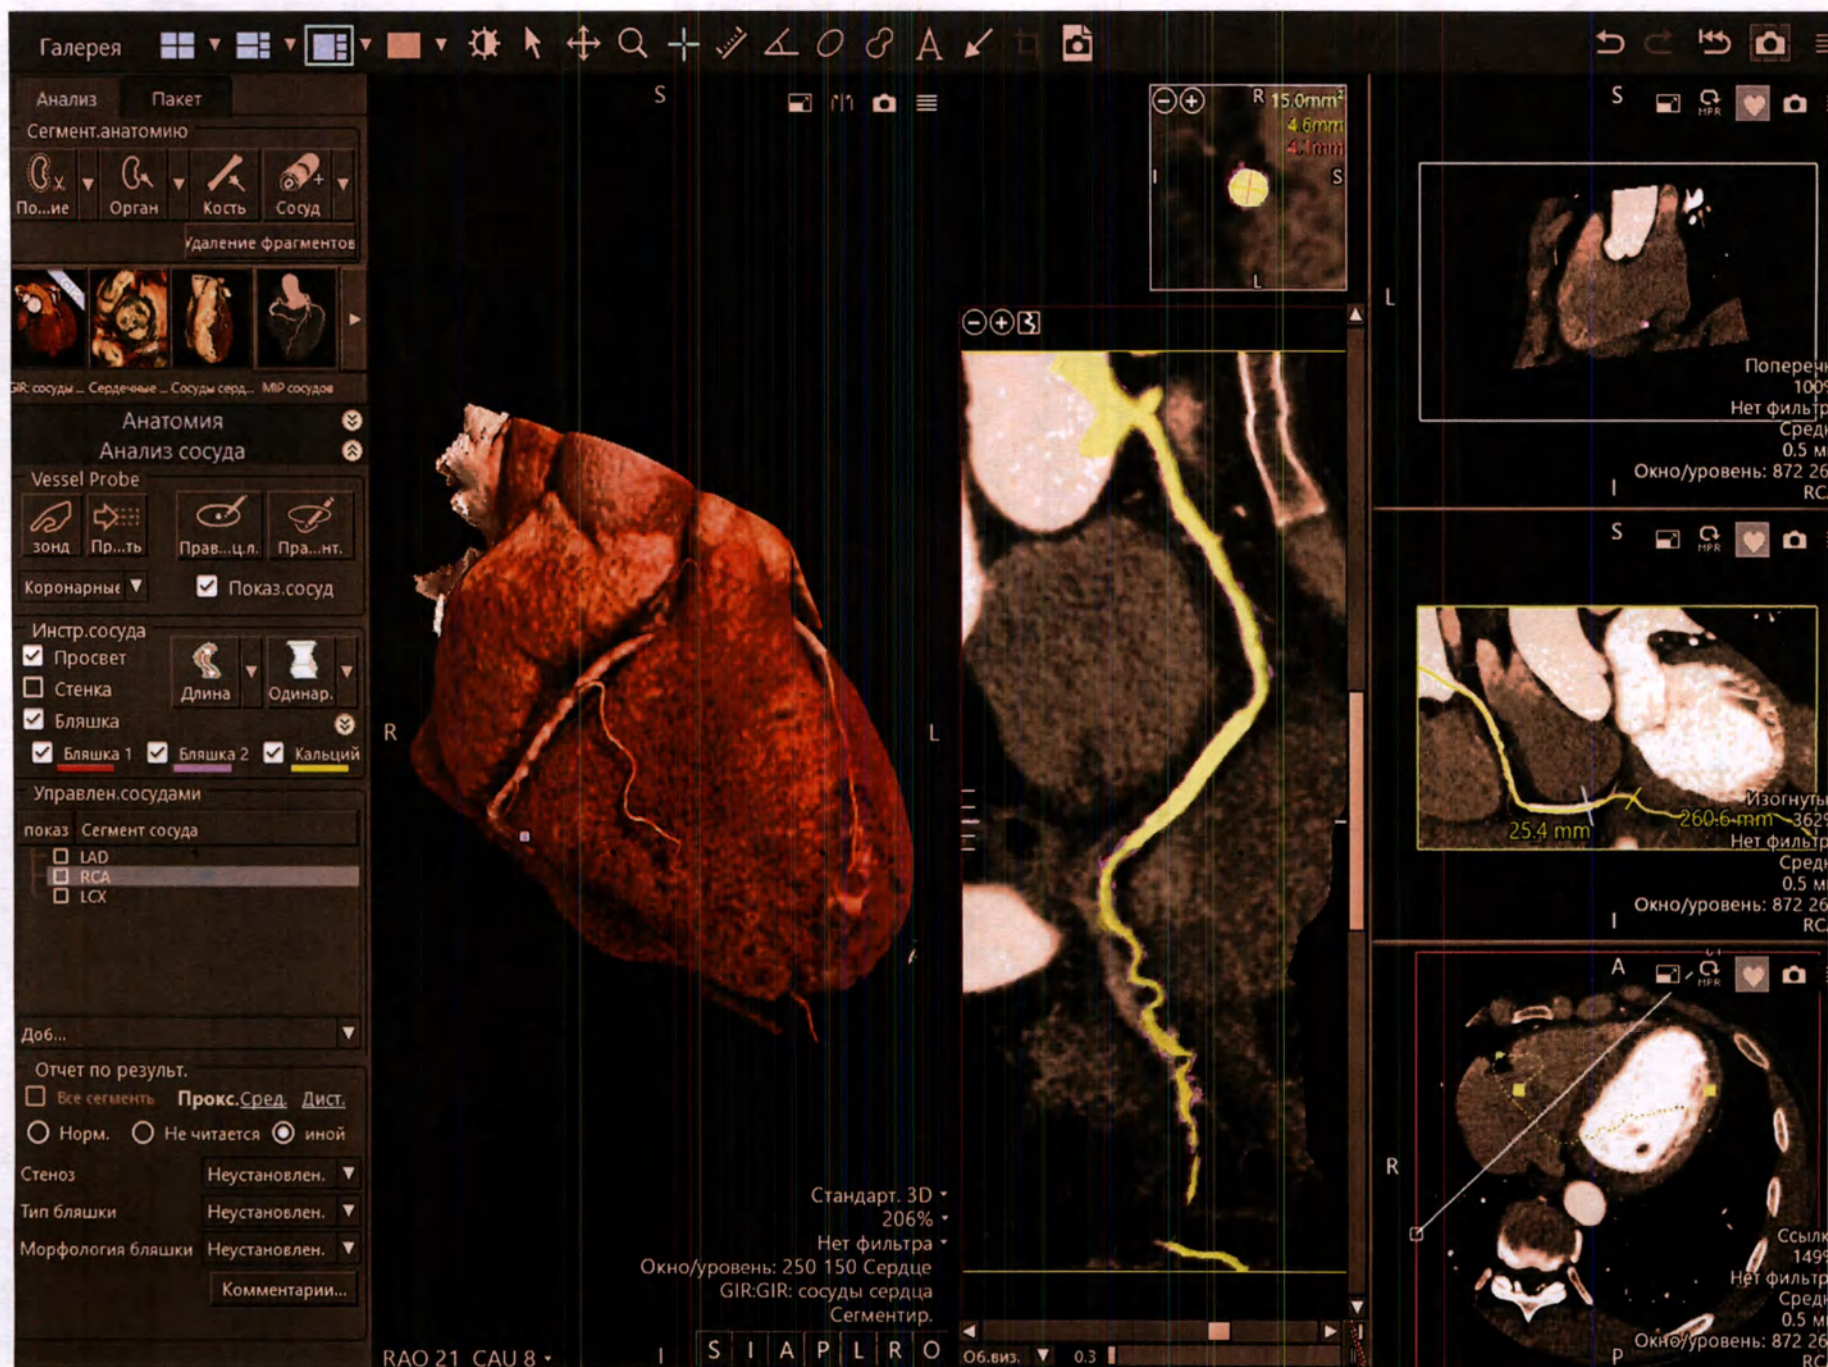


35. Приложение для функционального анализа сердца (при необходимости)

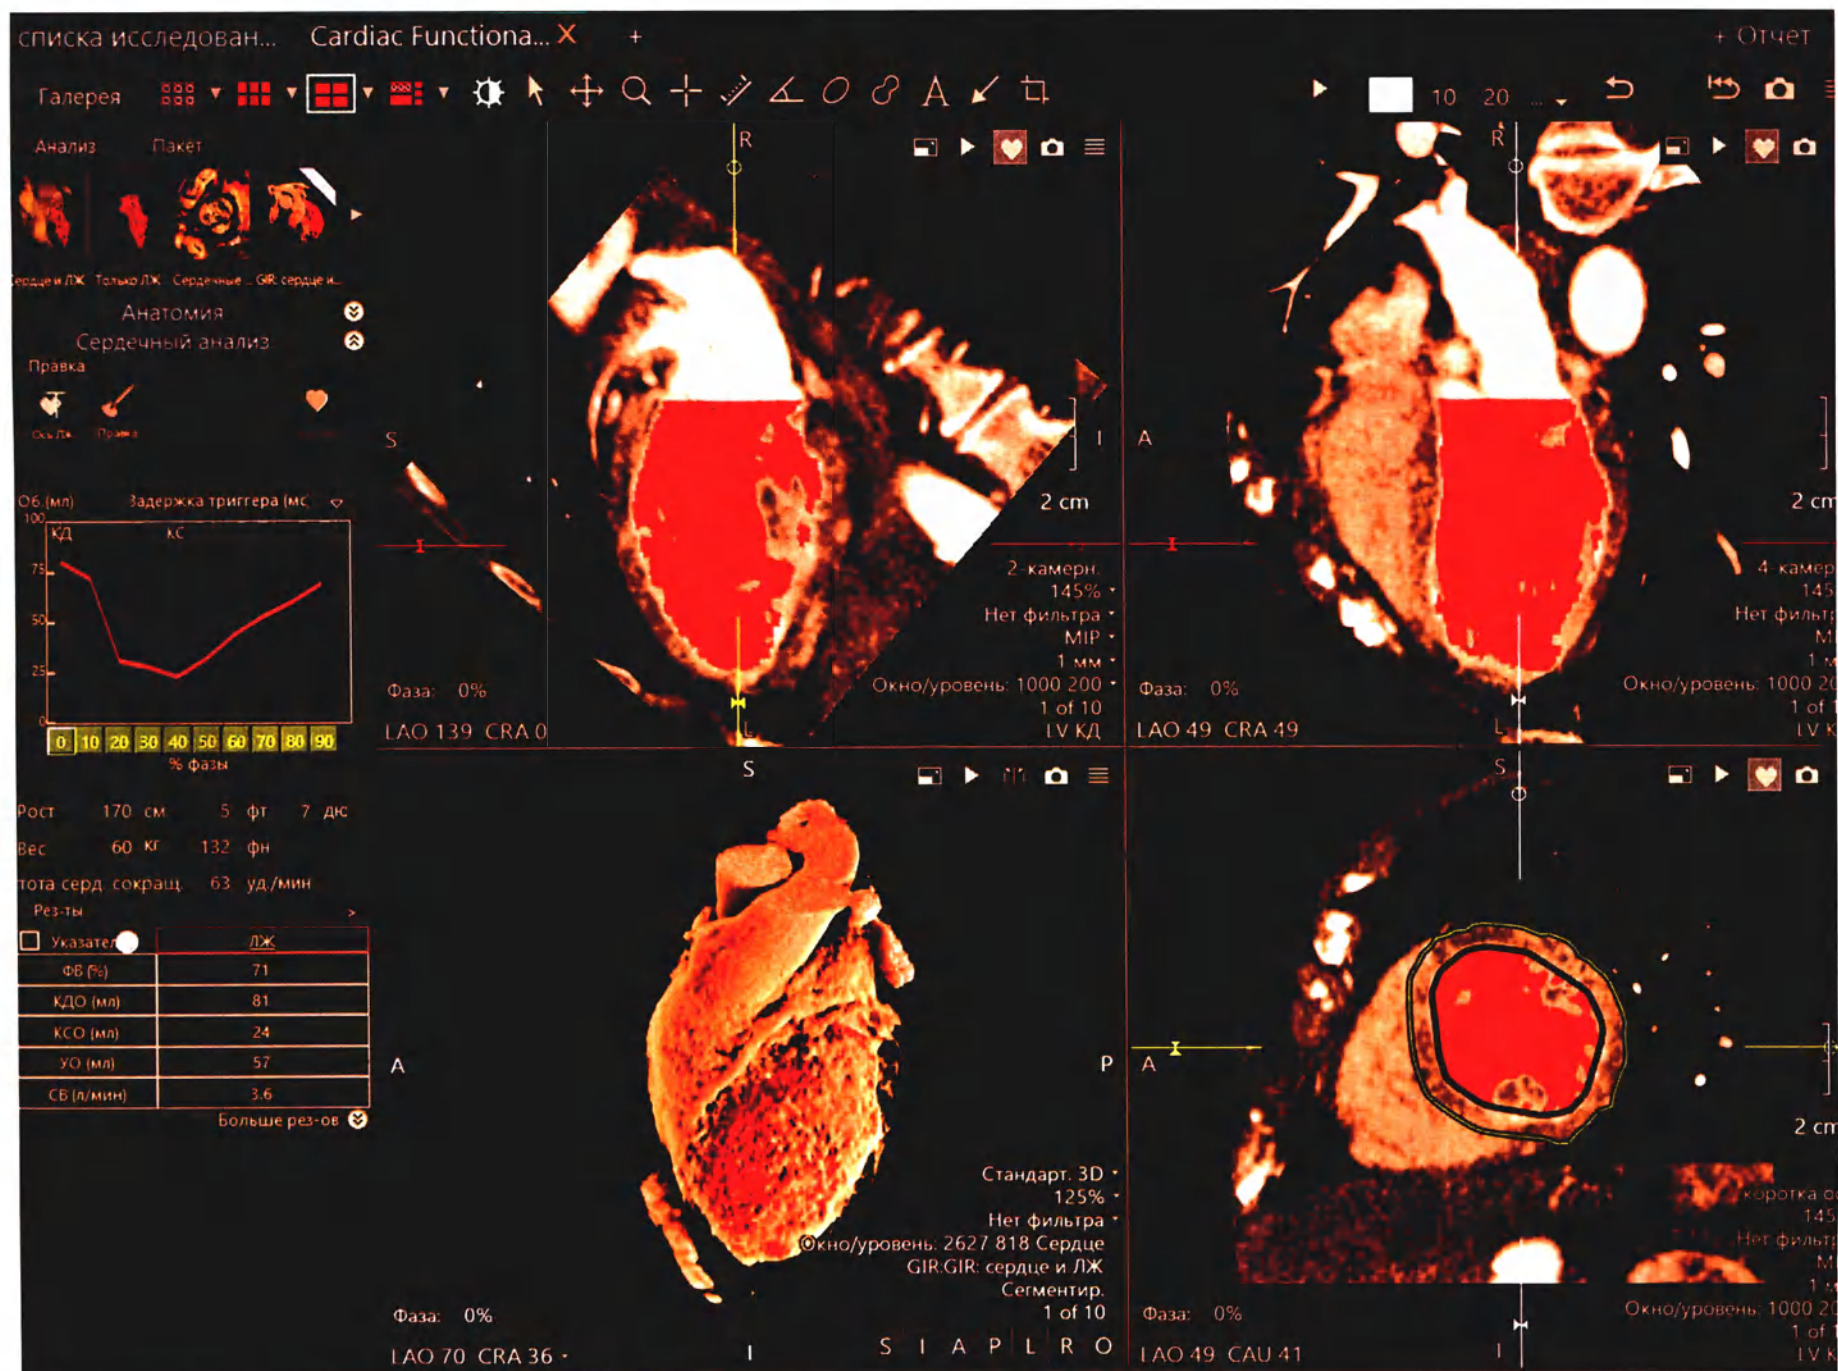


36. Приложение для многокамерного анализа функции сердца (при необходимости)

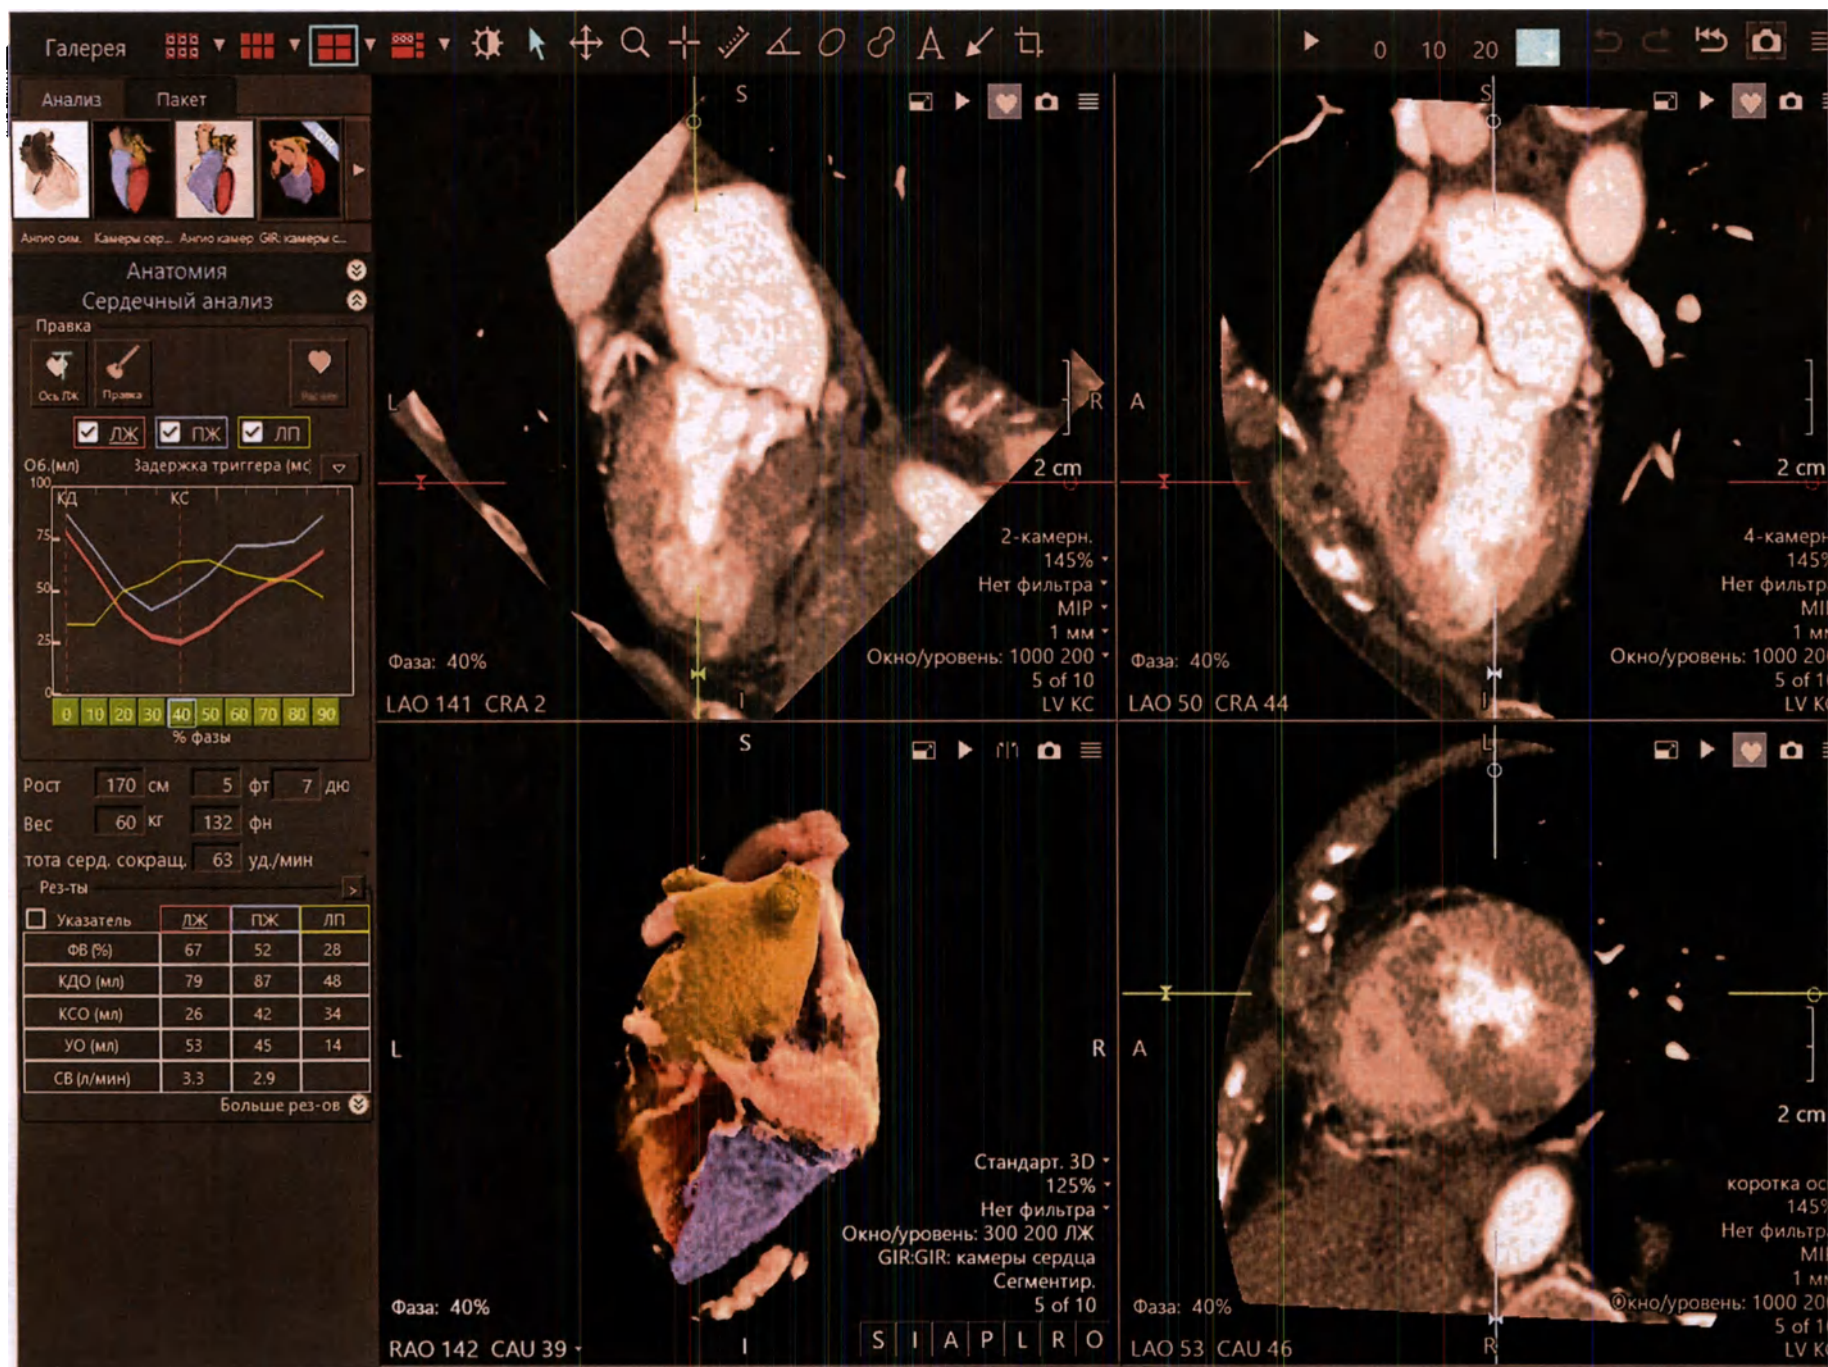


37. Приложение для определения жирового индекса (при необходимости)

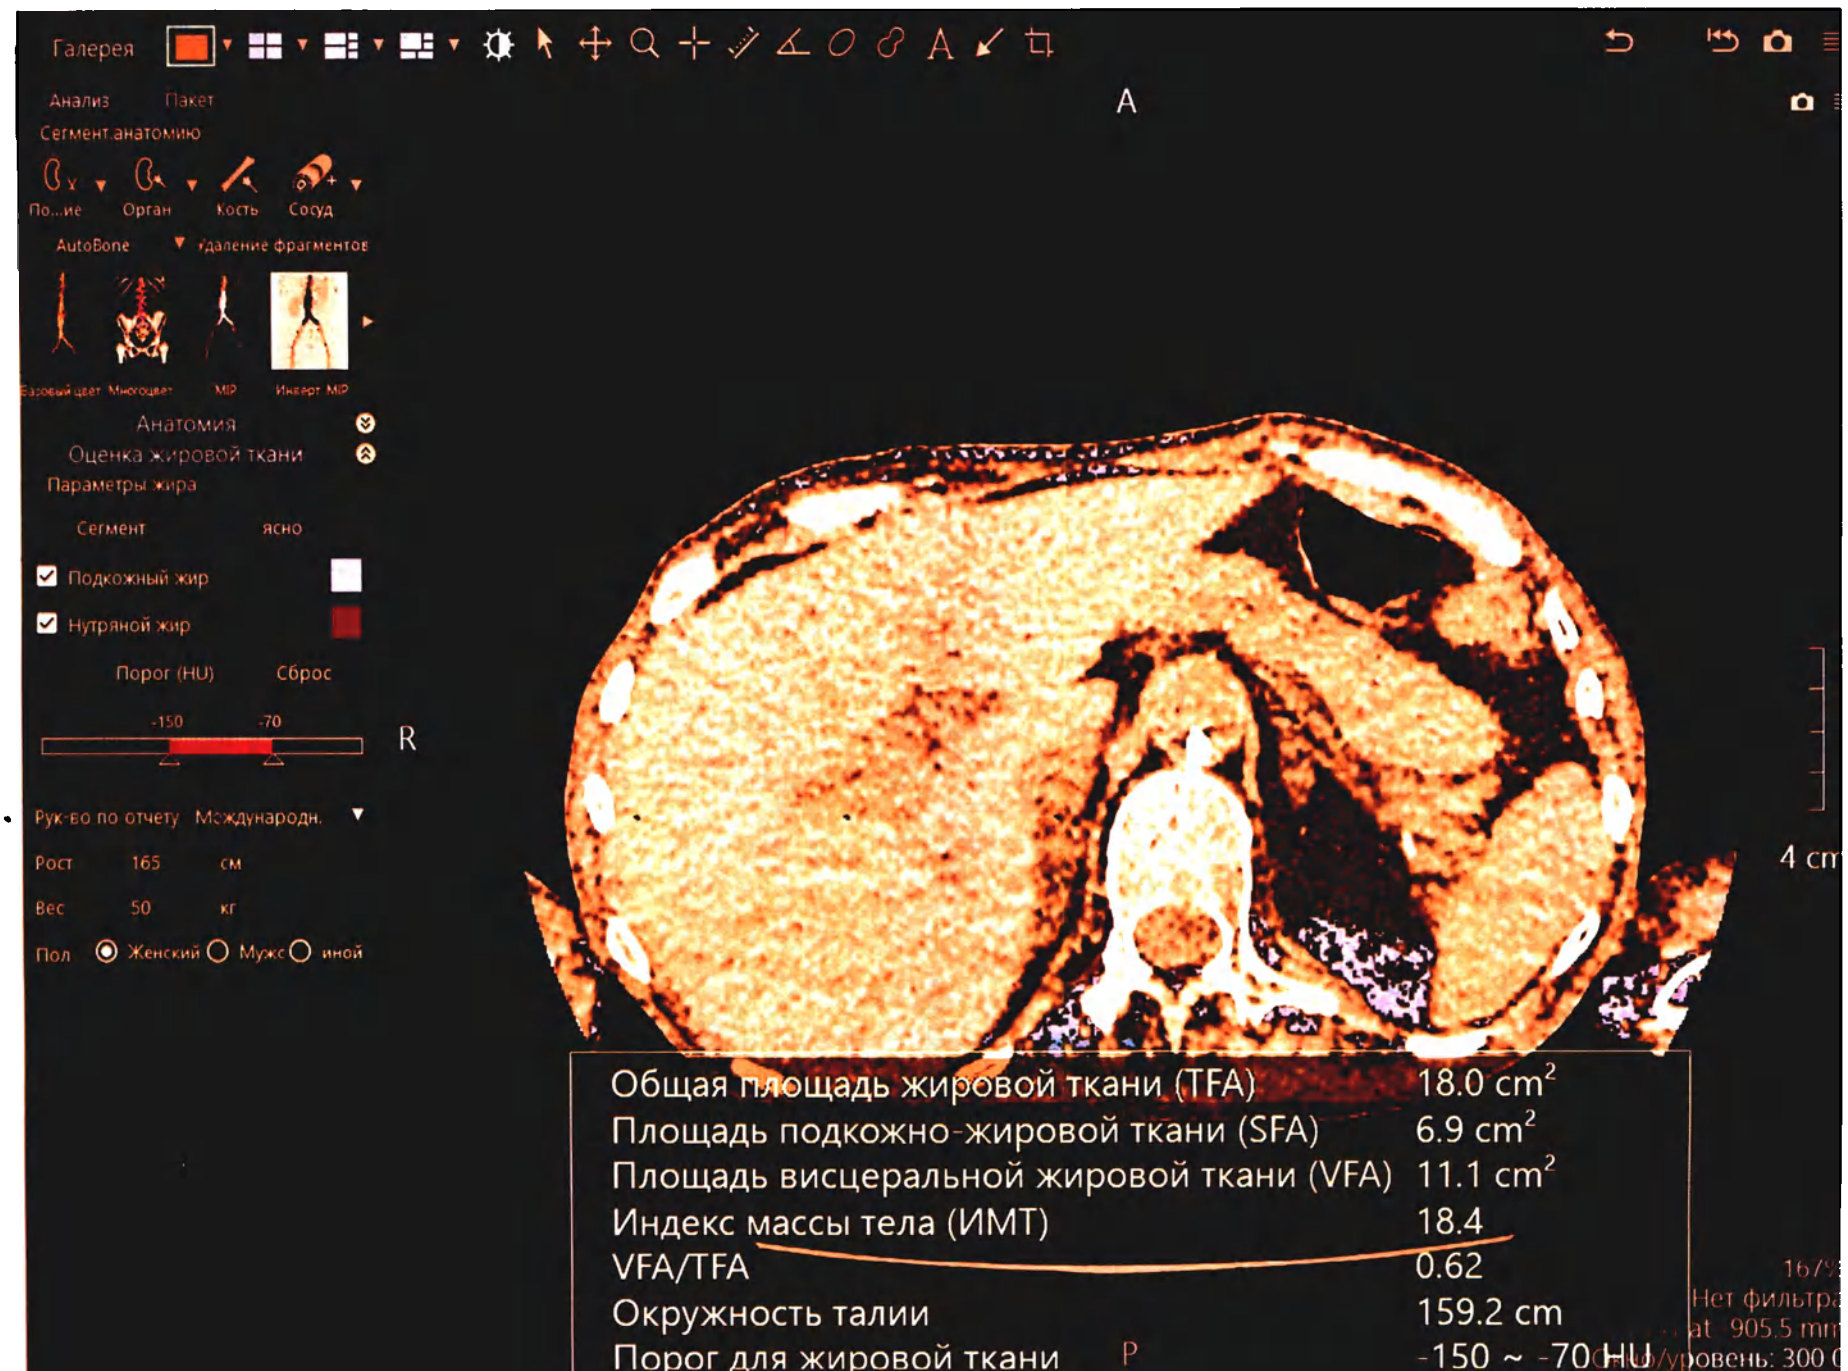


38. Приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек (при необходимости)

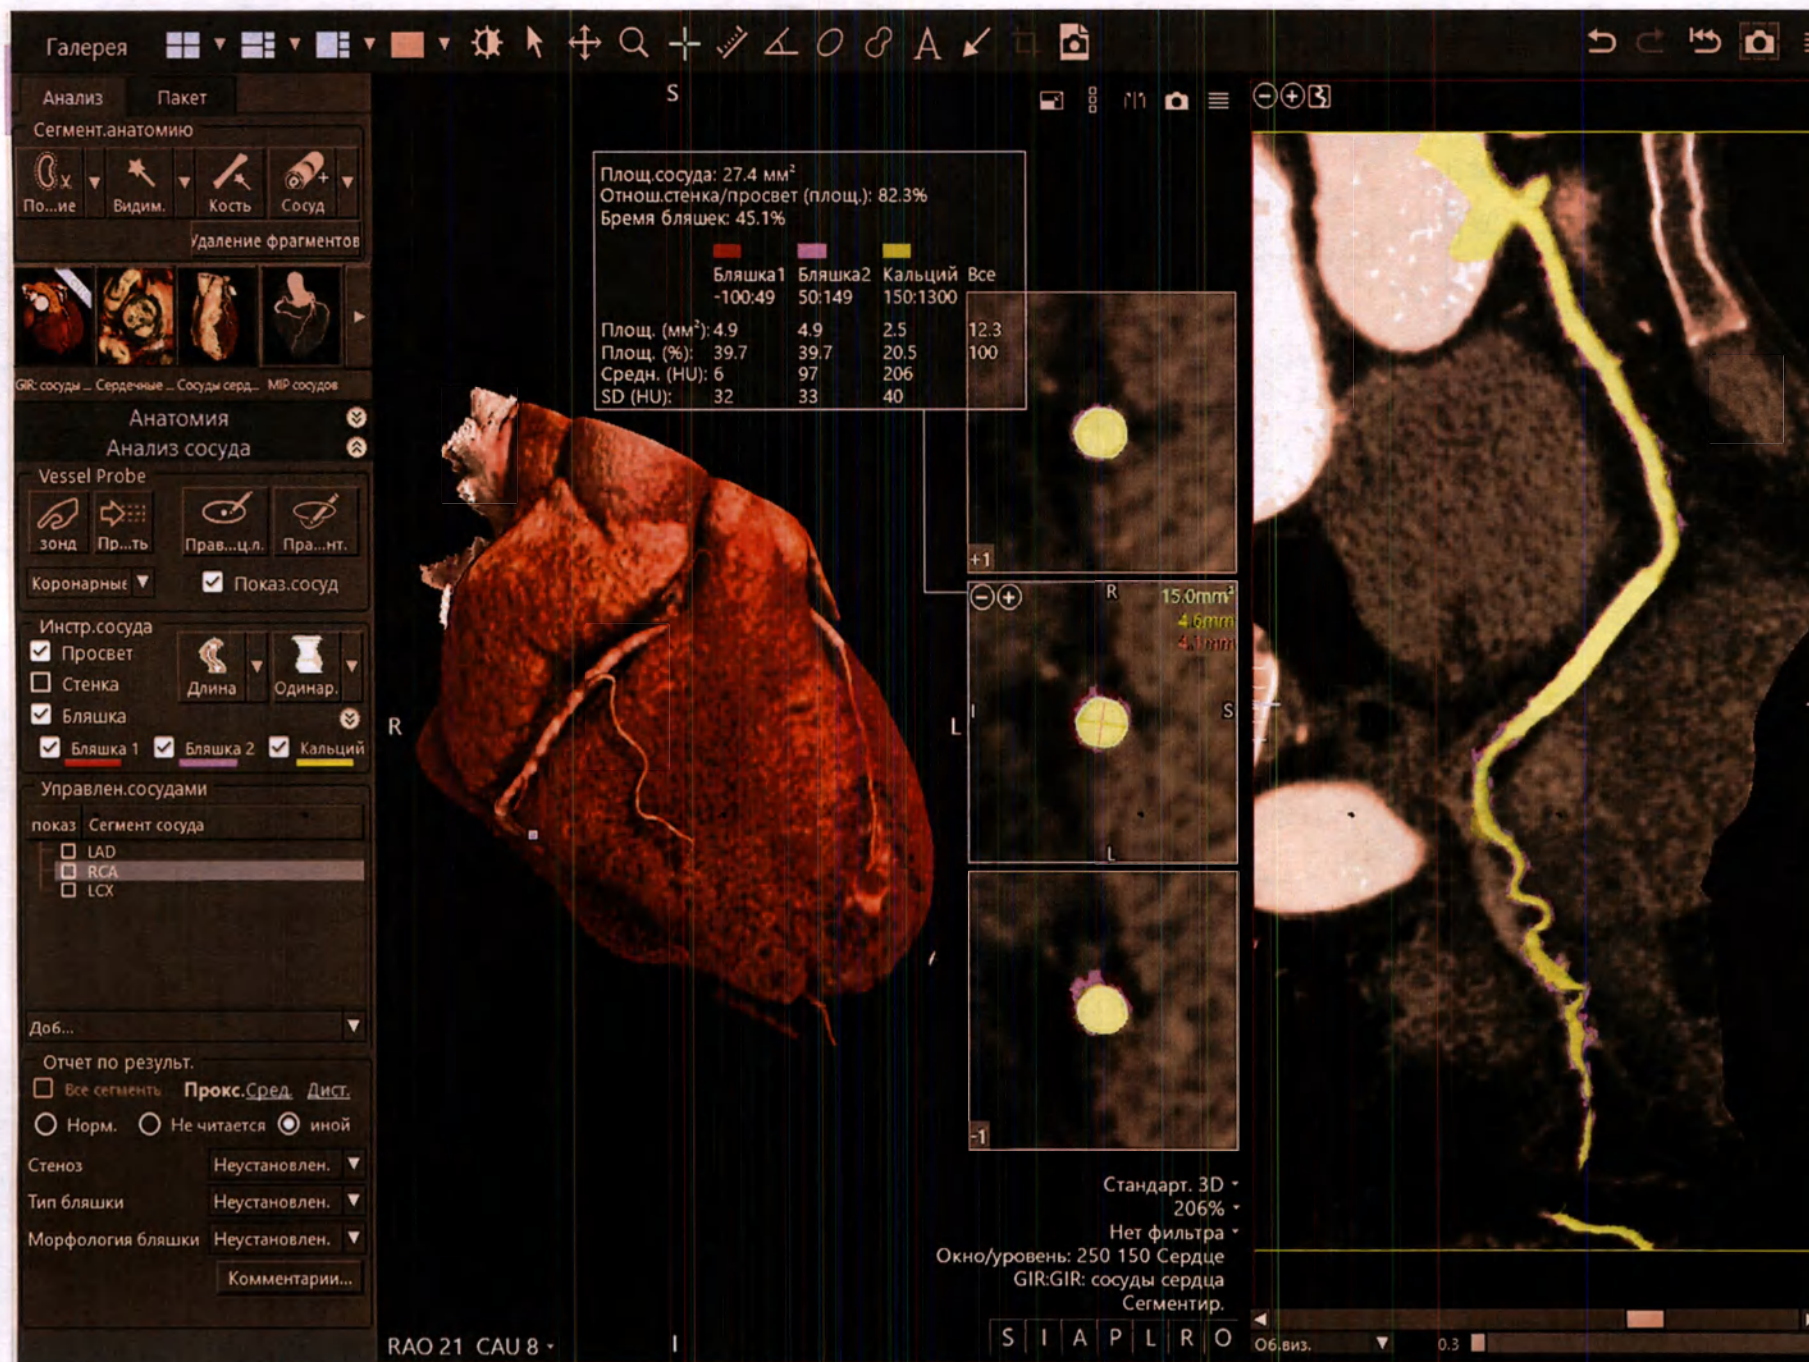


39. Приложение для оценки перфузии миокарда (при необходимости)

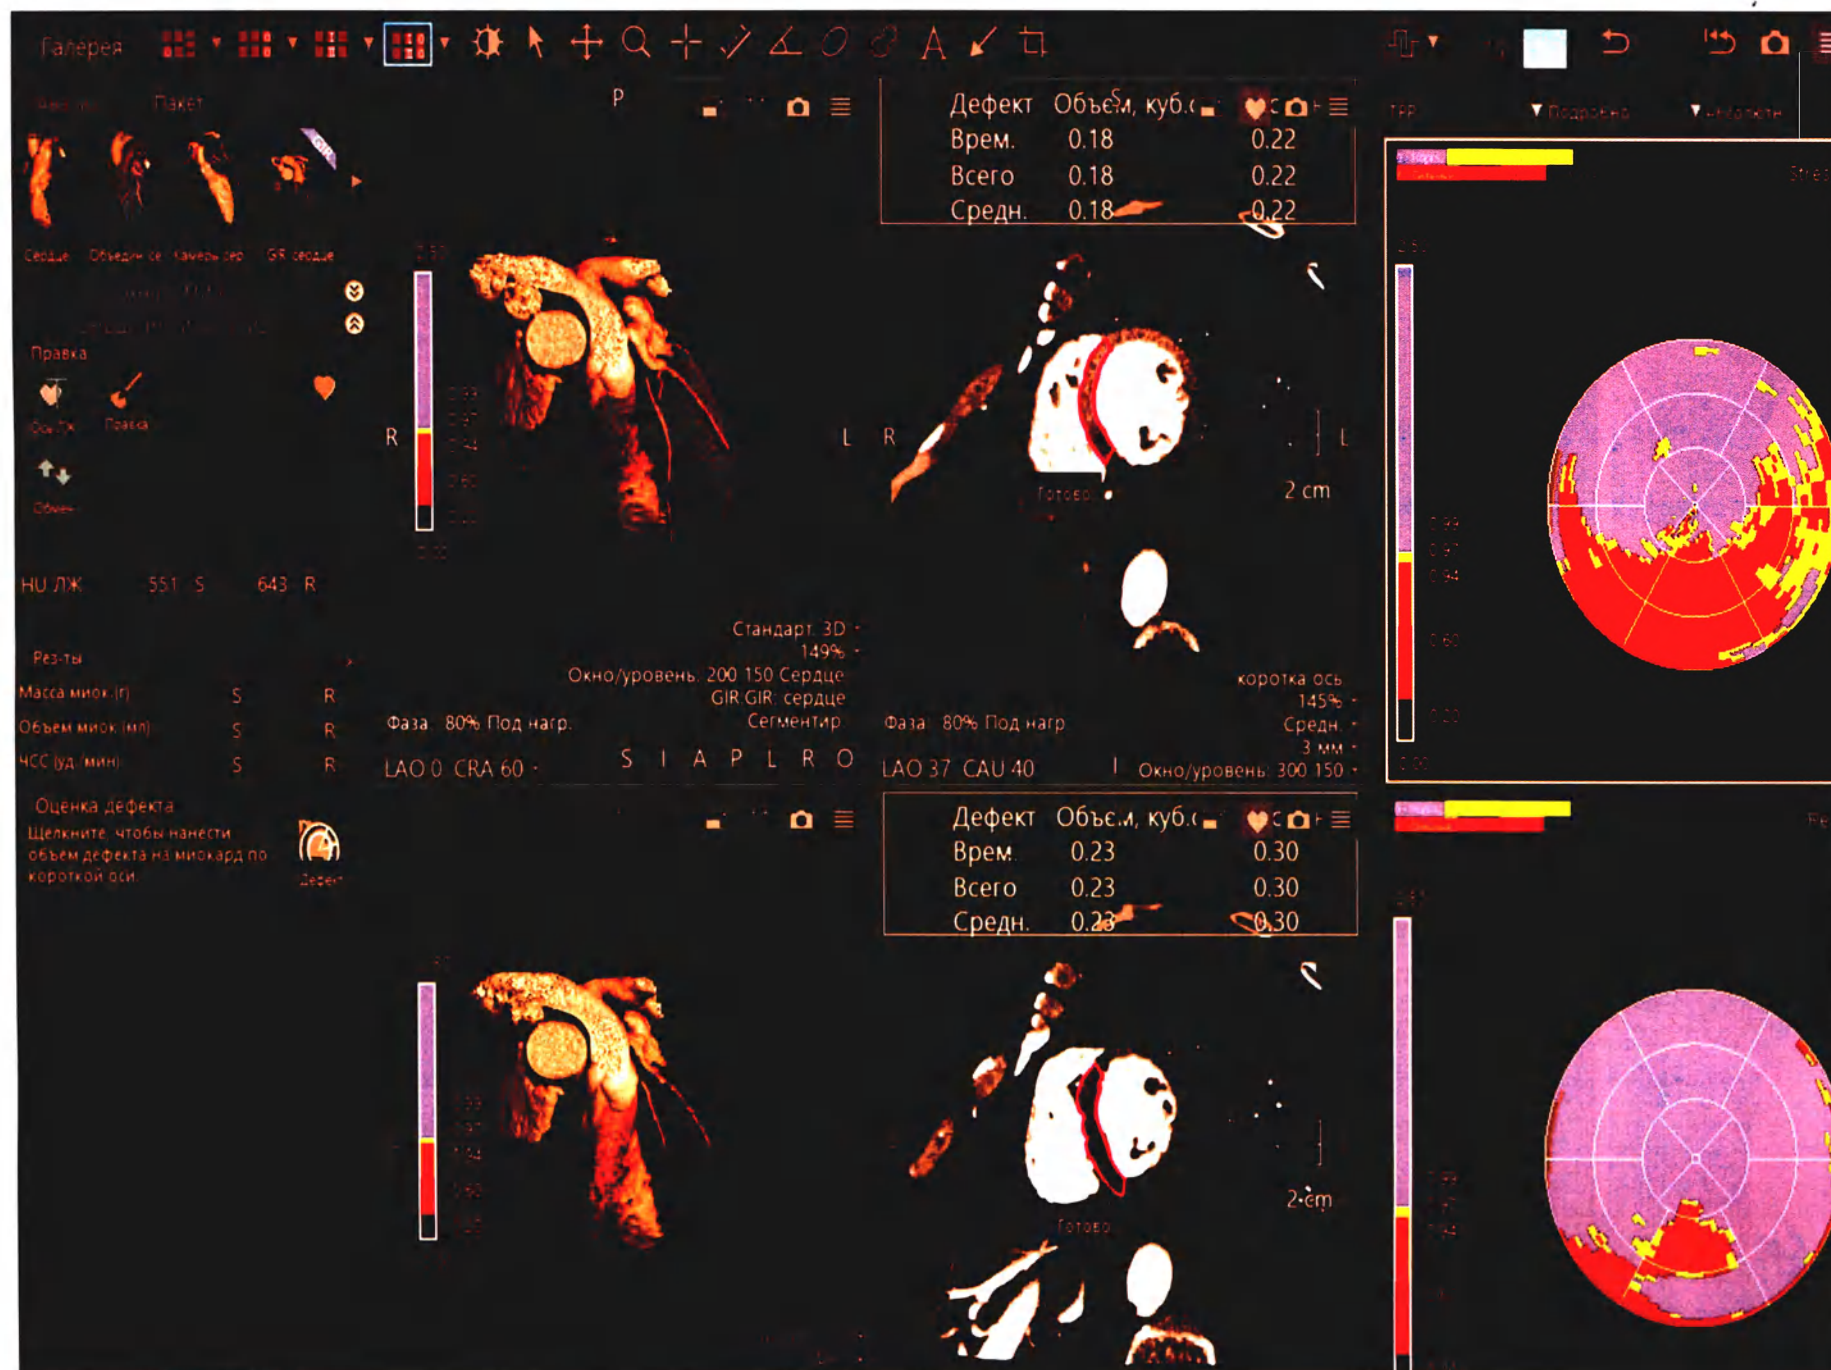


40. Приложение для анализа объемных данных перфузии головного мозга (при необходимости)

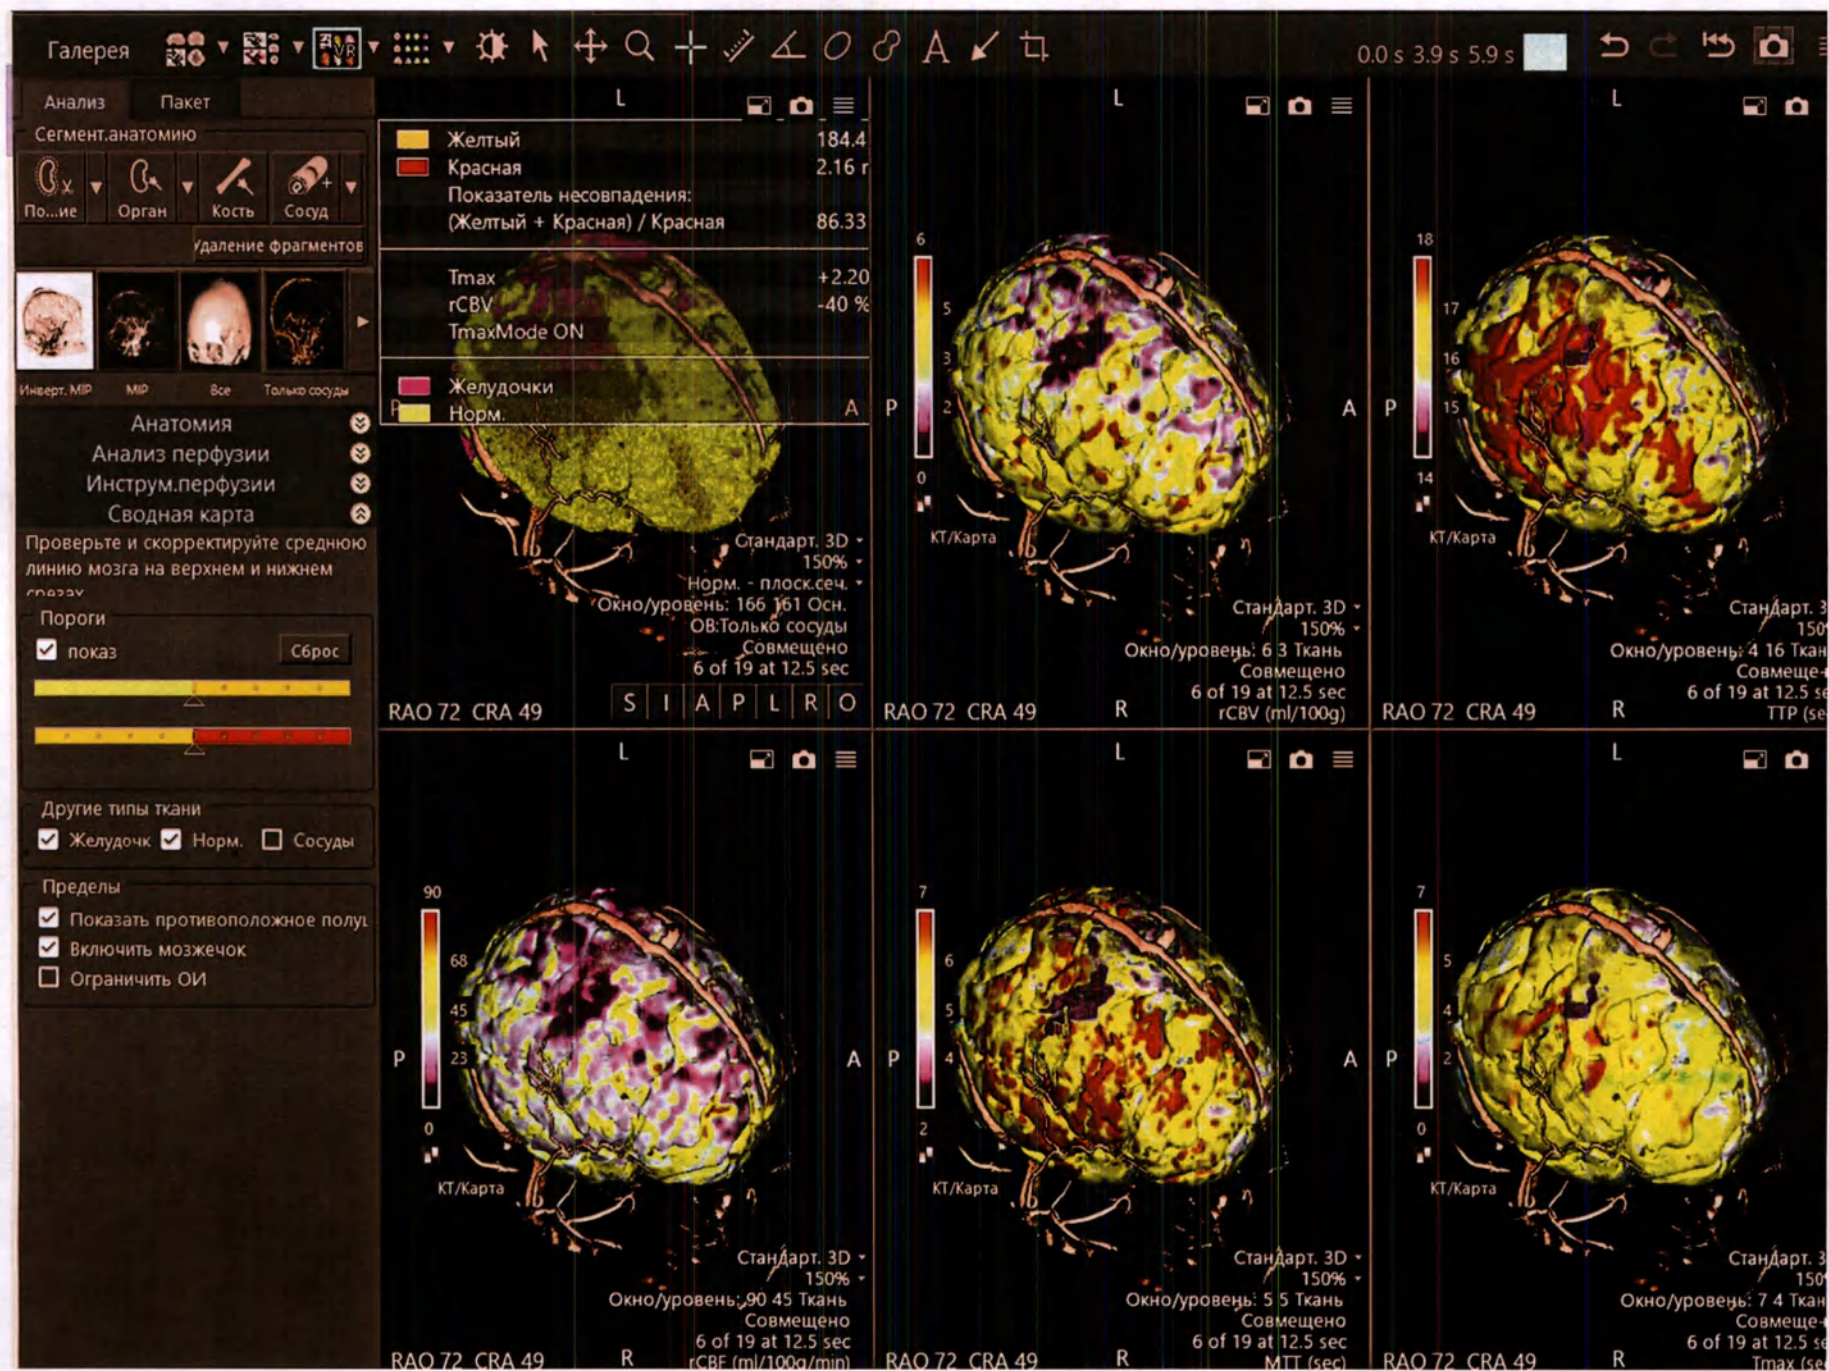


41. Приложение для оценки перфузии внутренних органов (при необходимости)

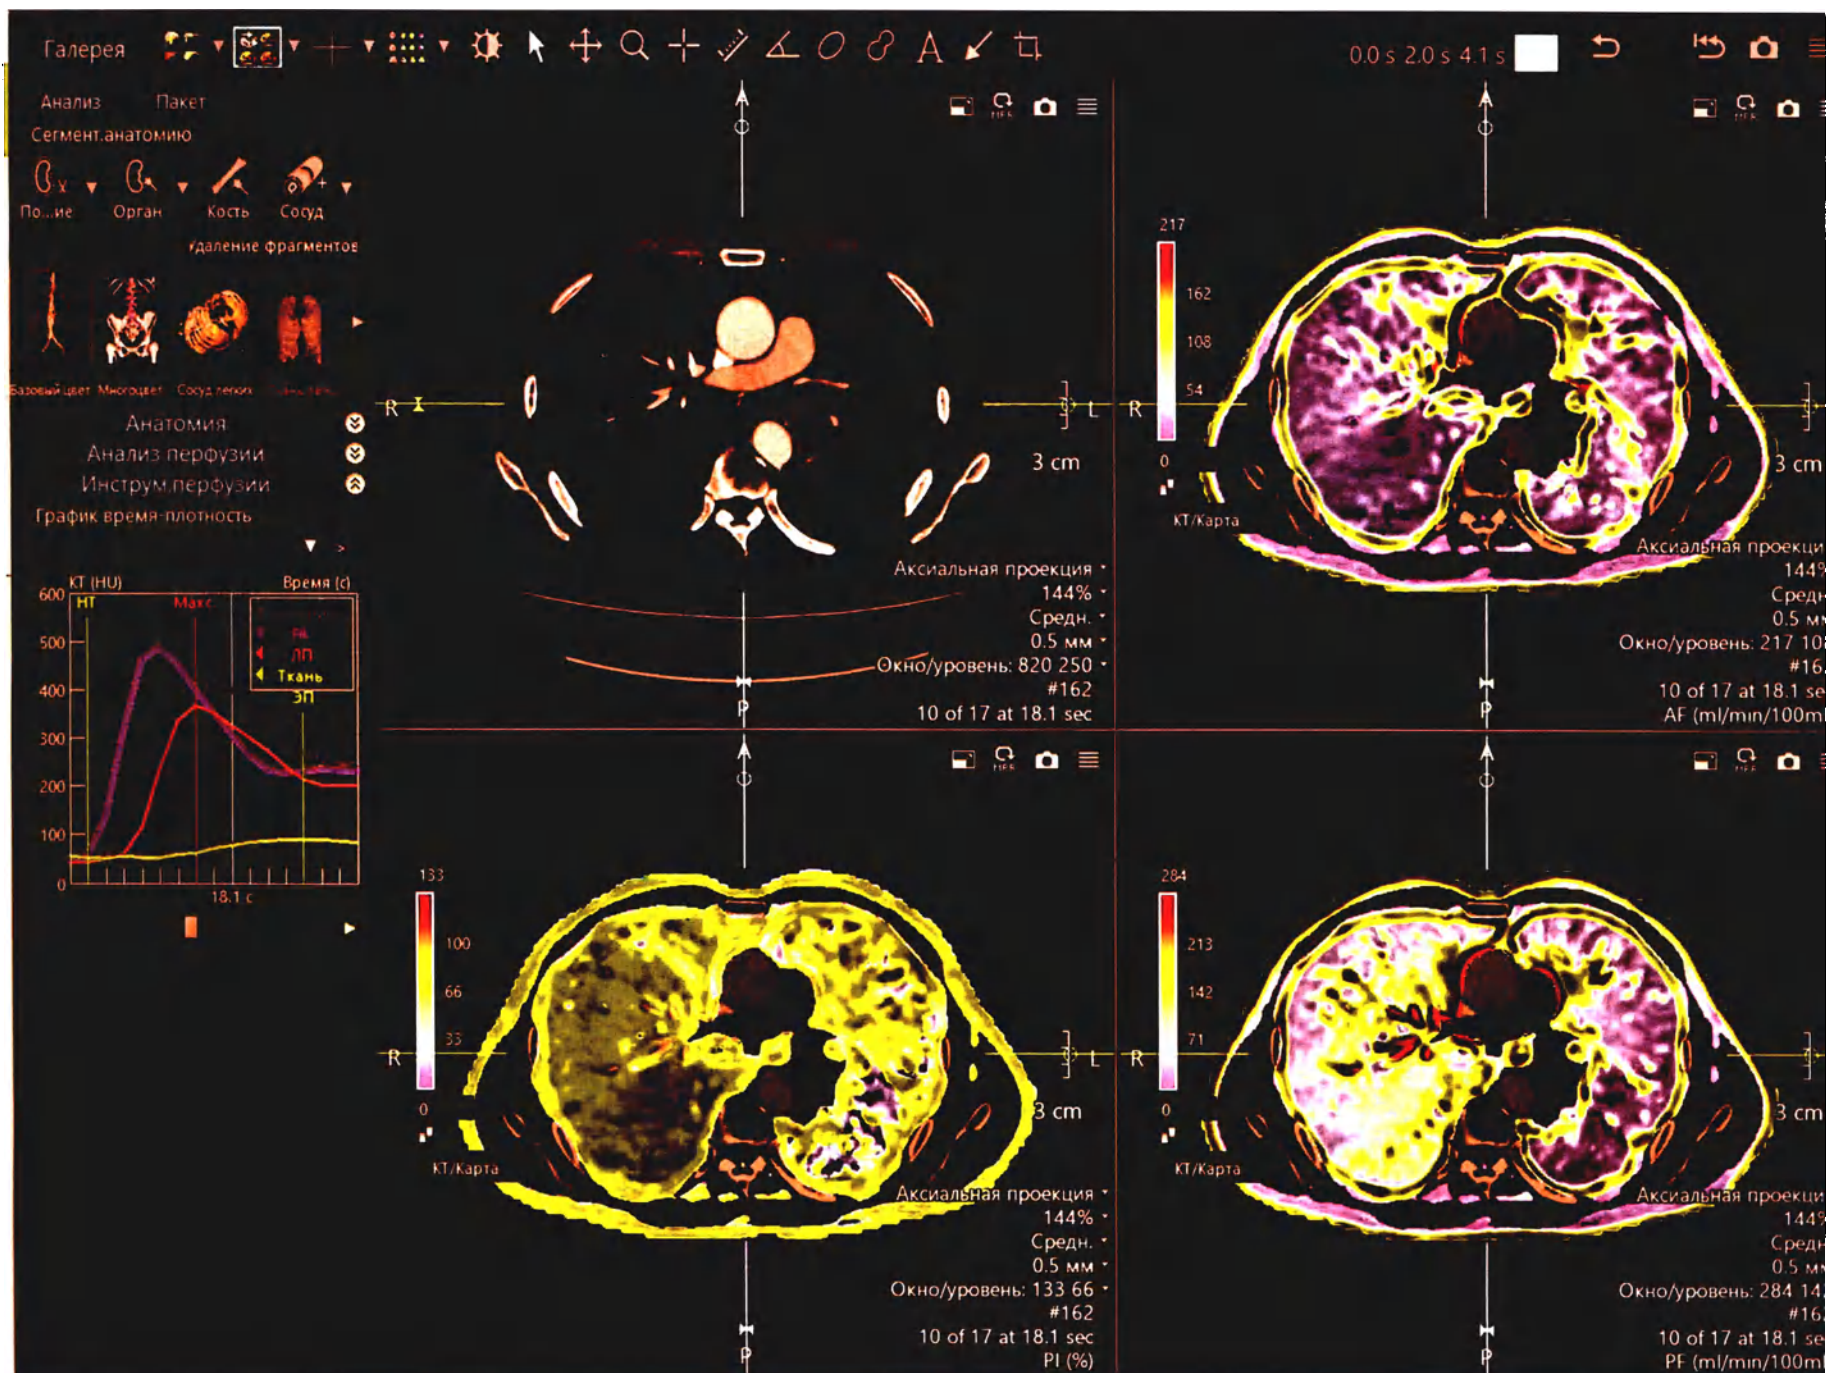


42. Приложение для анализа двухэнергетических изображений (при необходимости)

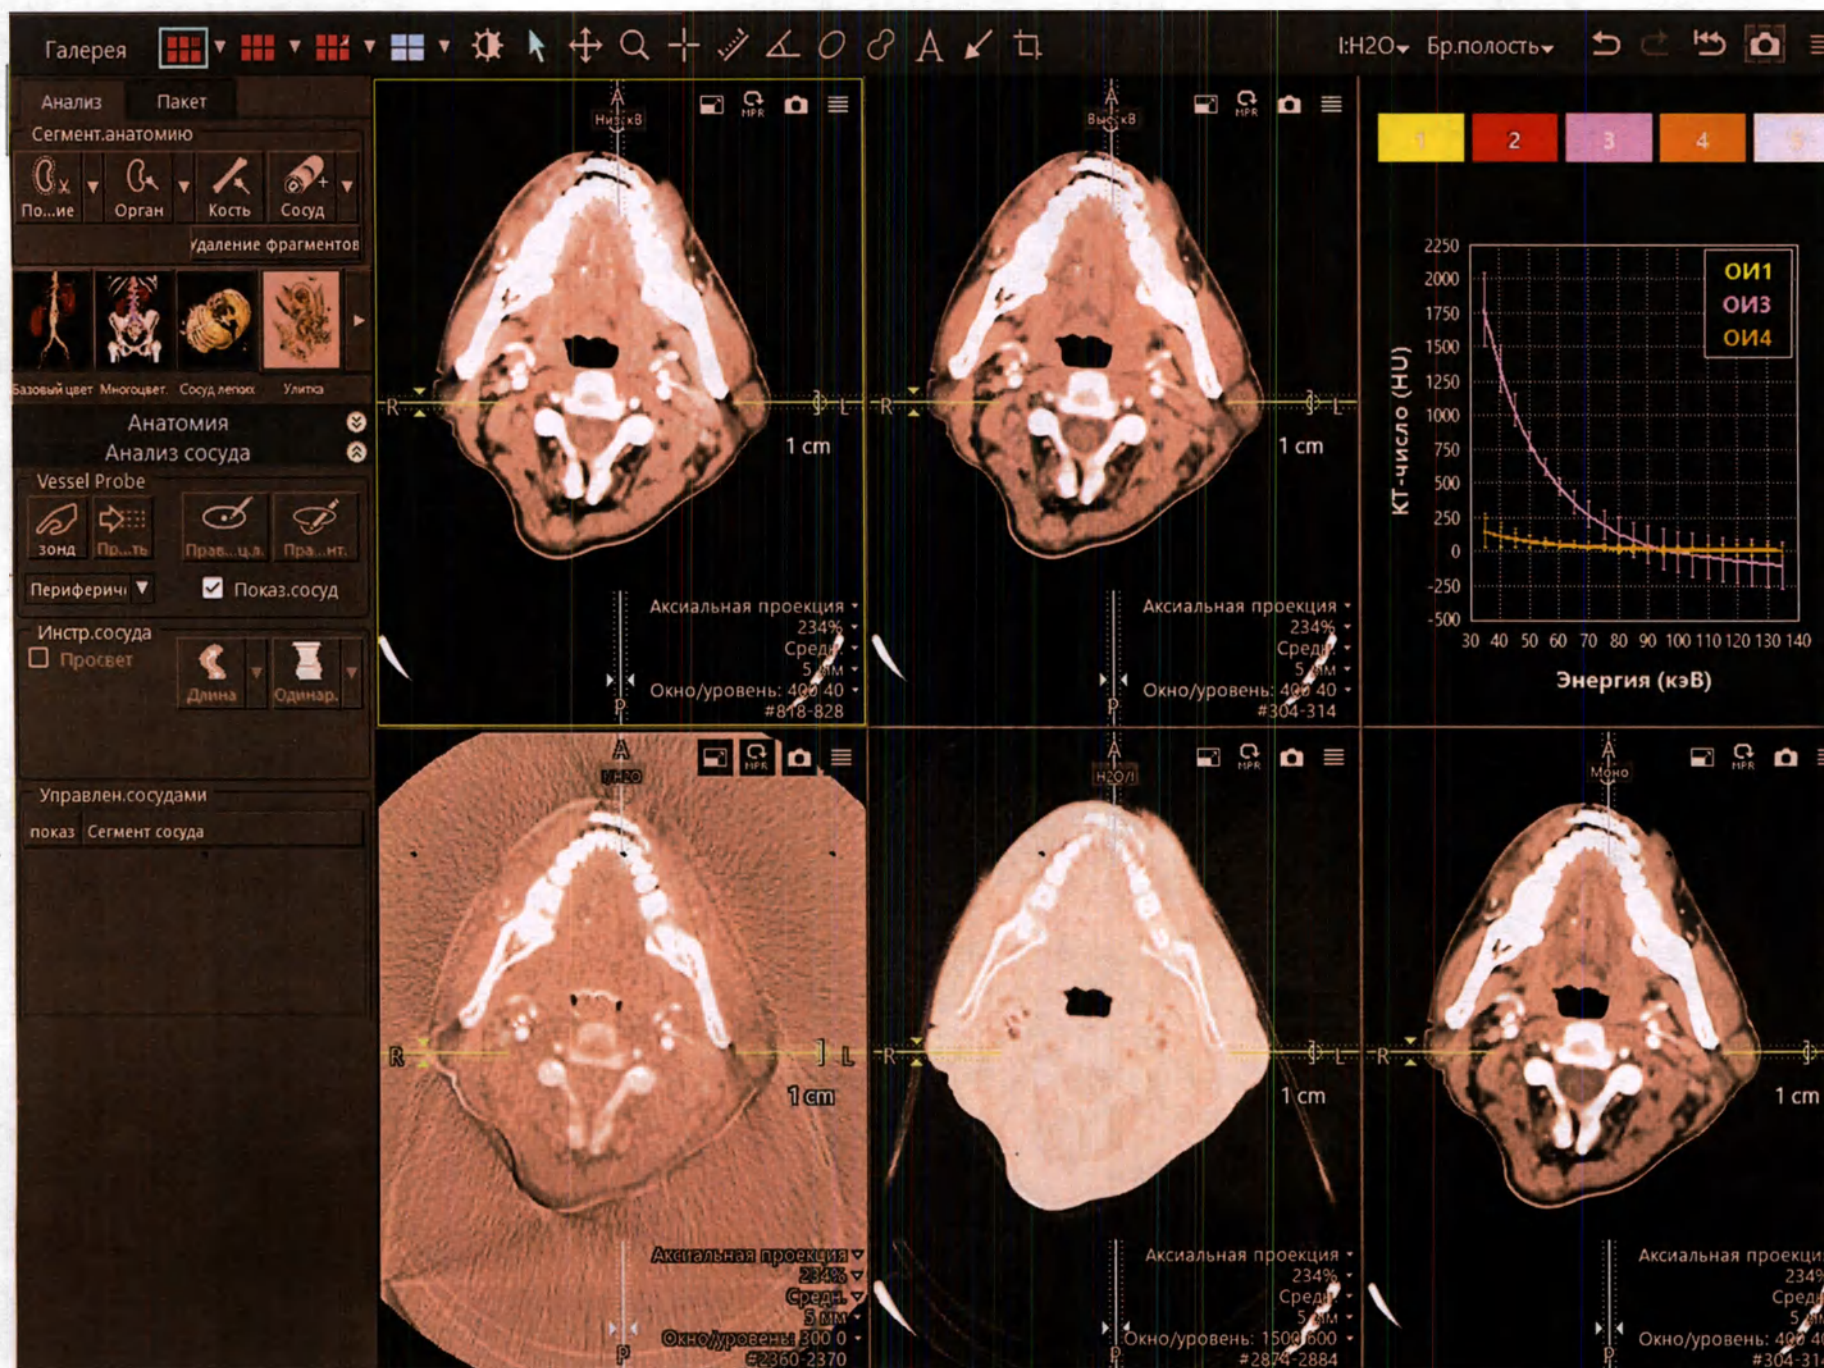


43. Приложение для виртуальной колоноскопии, включая функцию компьютеризированного поиска полипов (при необходимости)

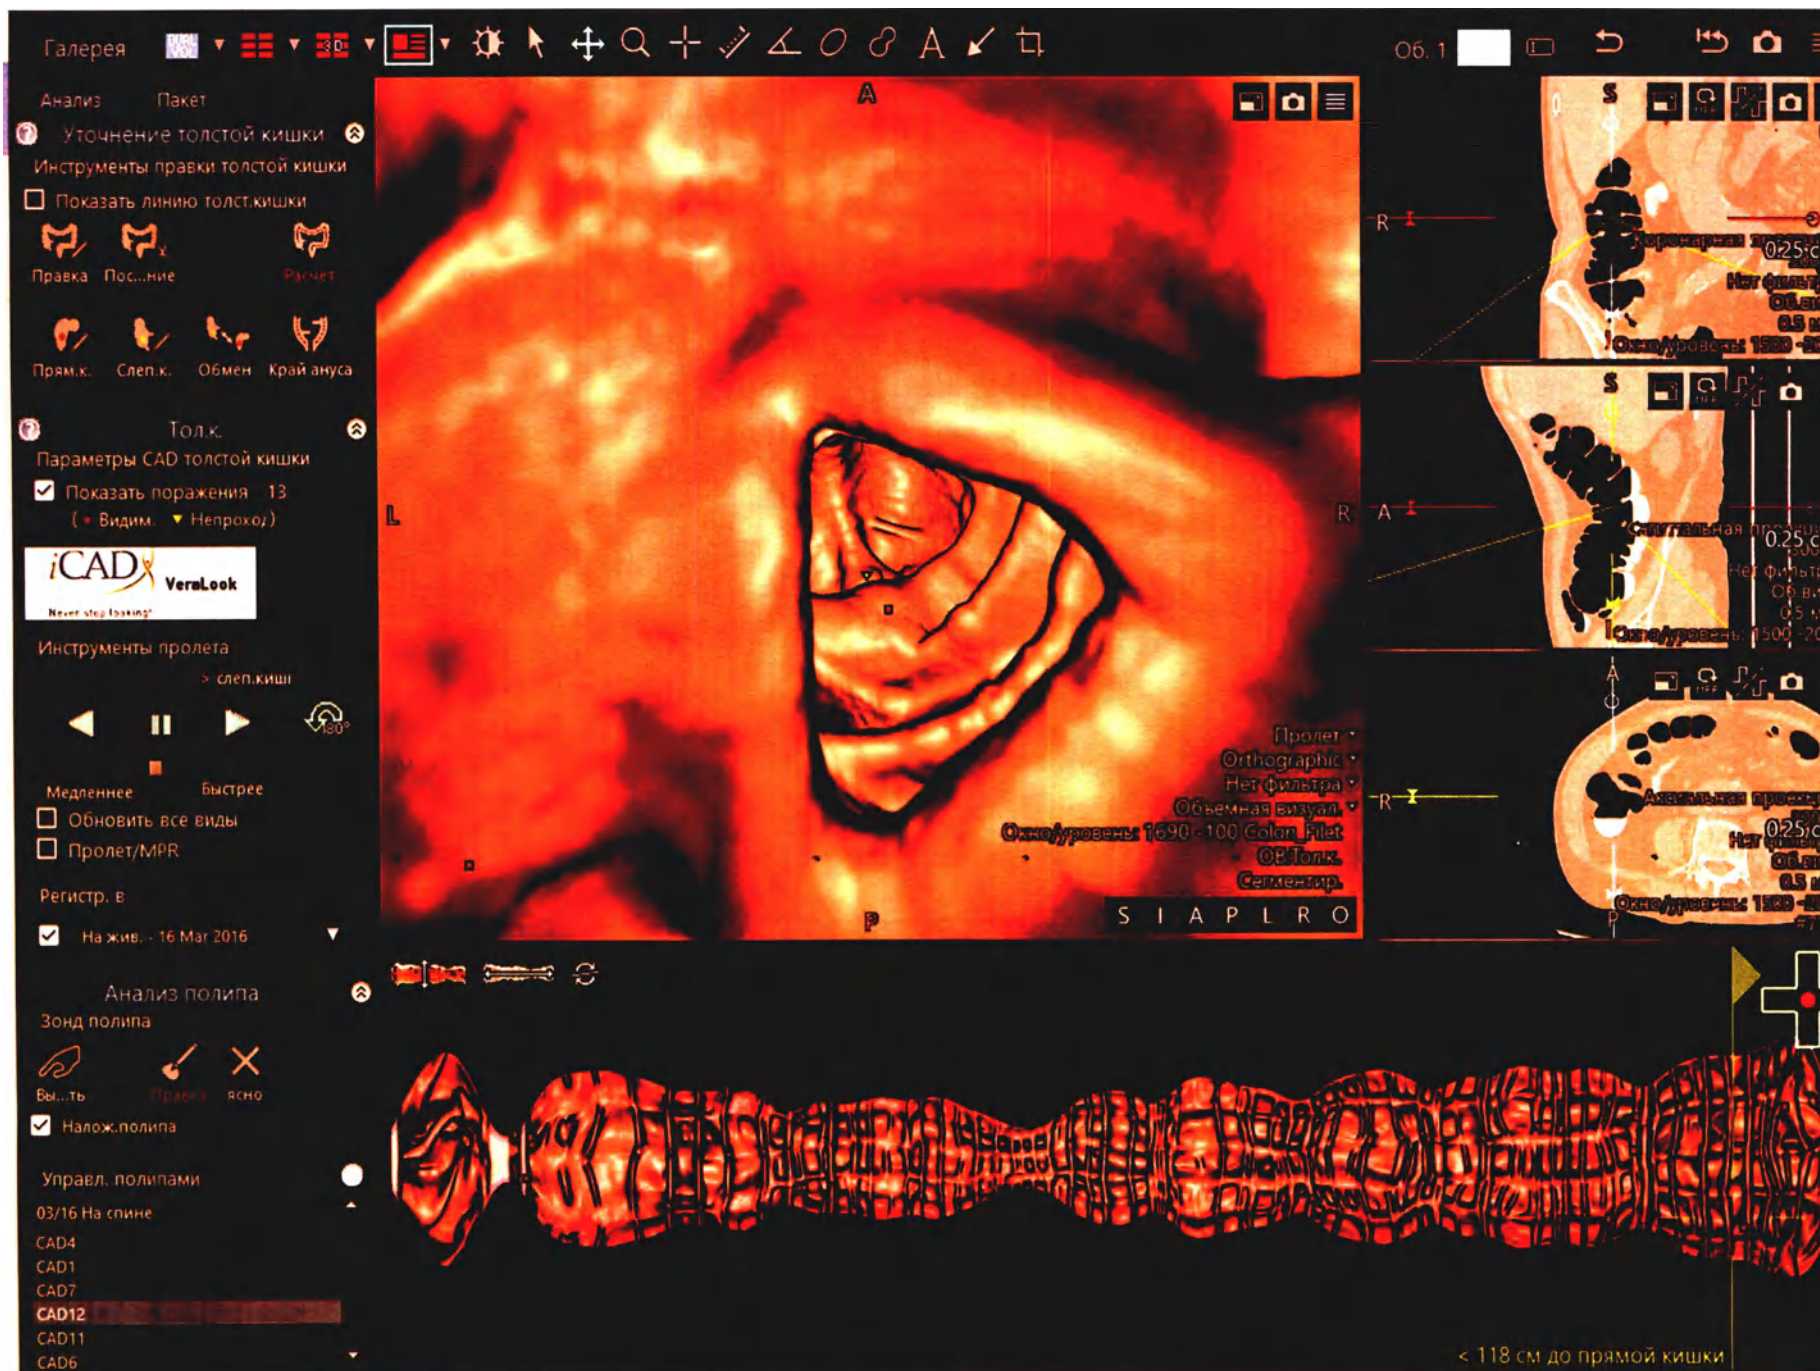


44. Приложение для КТ-анализа узелковых образований в легких с функцией компьютеризированного поиска (при необходимости)

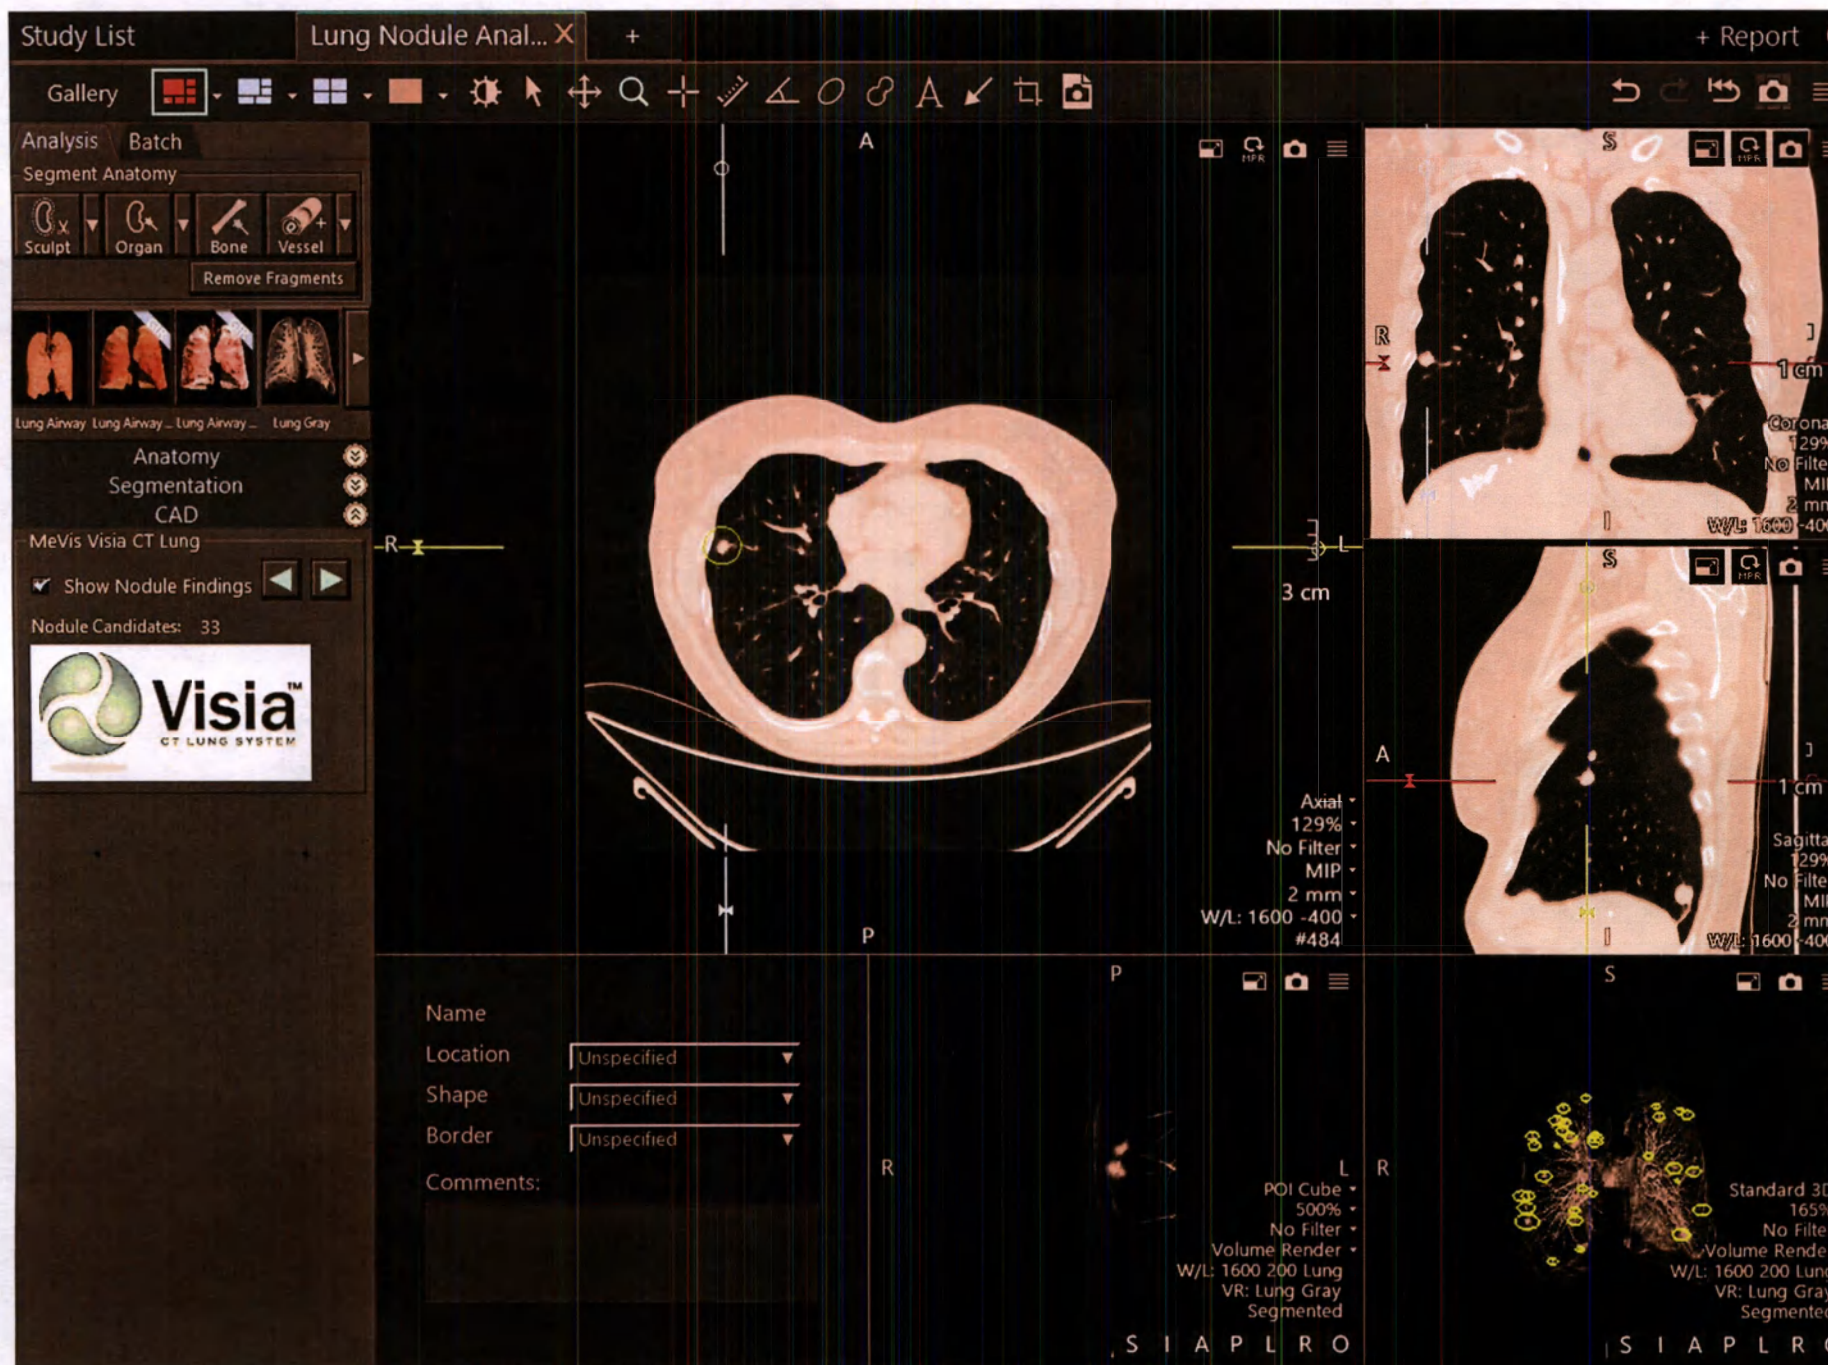


45. Приложение для анализа стоматологических изображений (при необходимости)

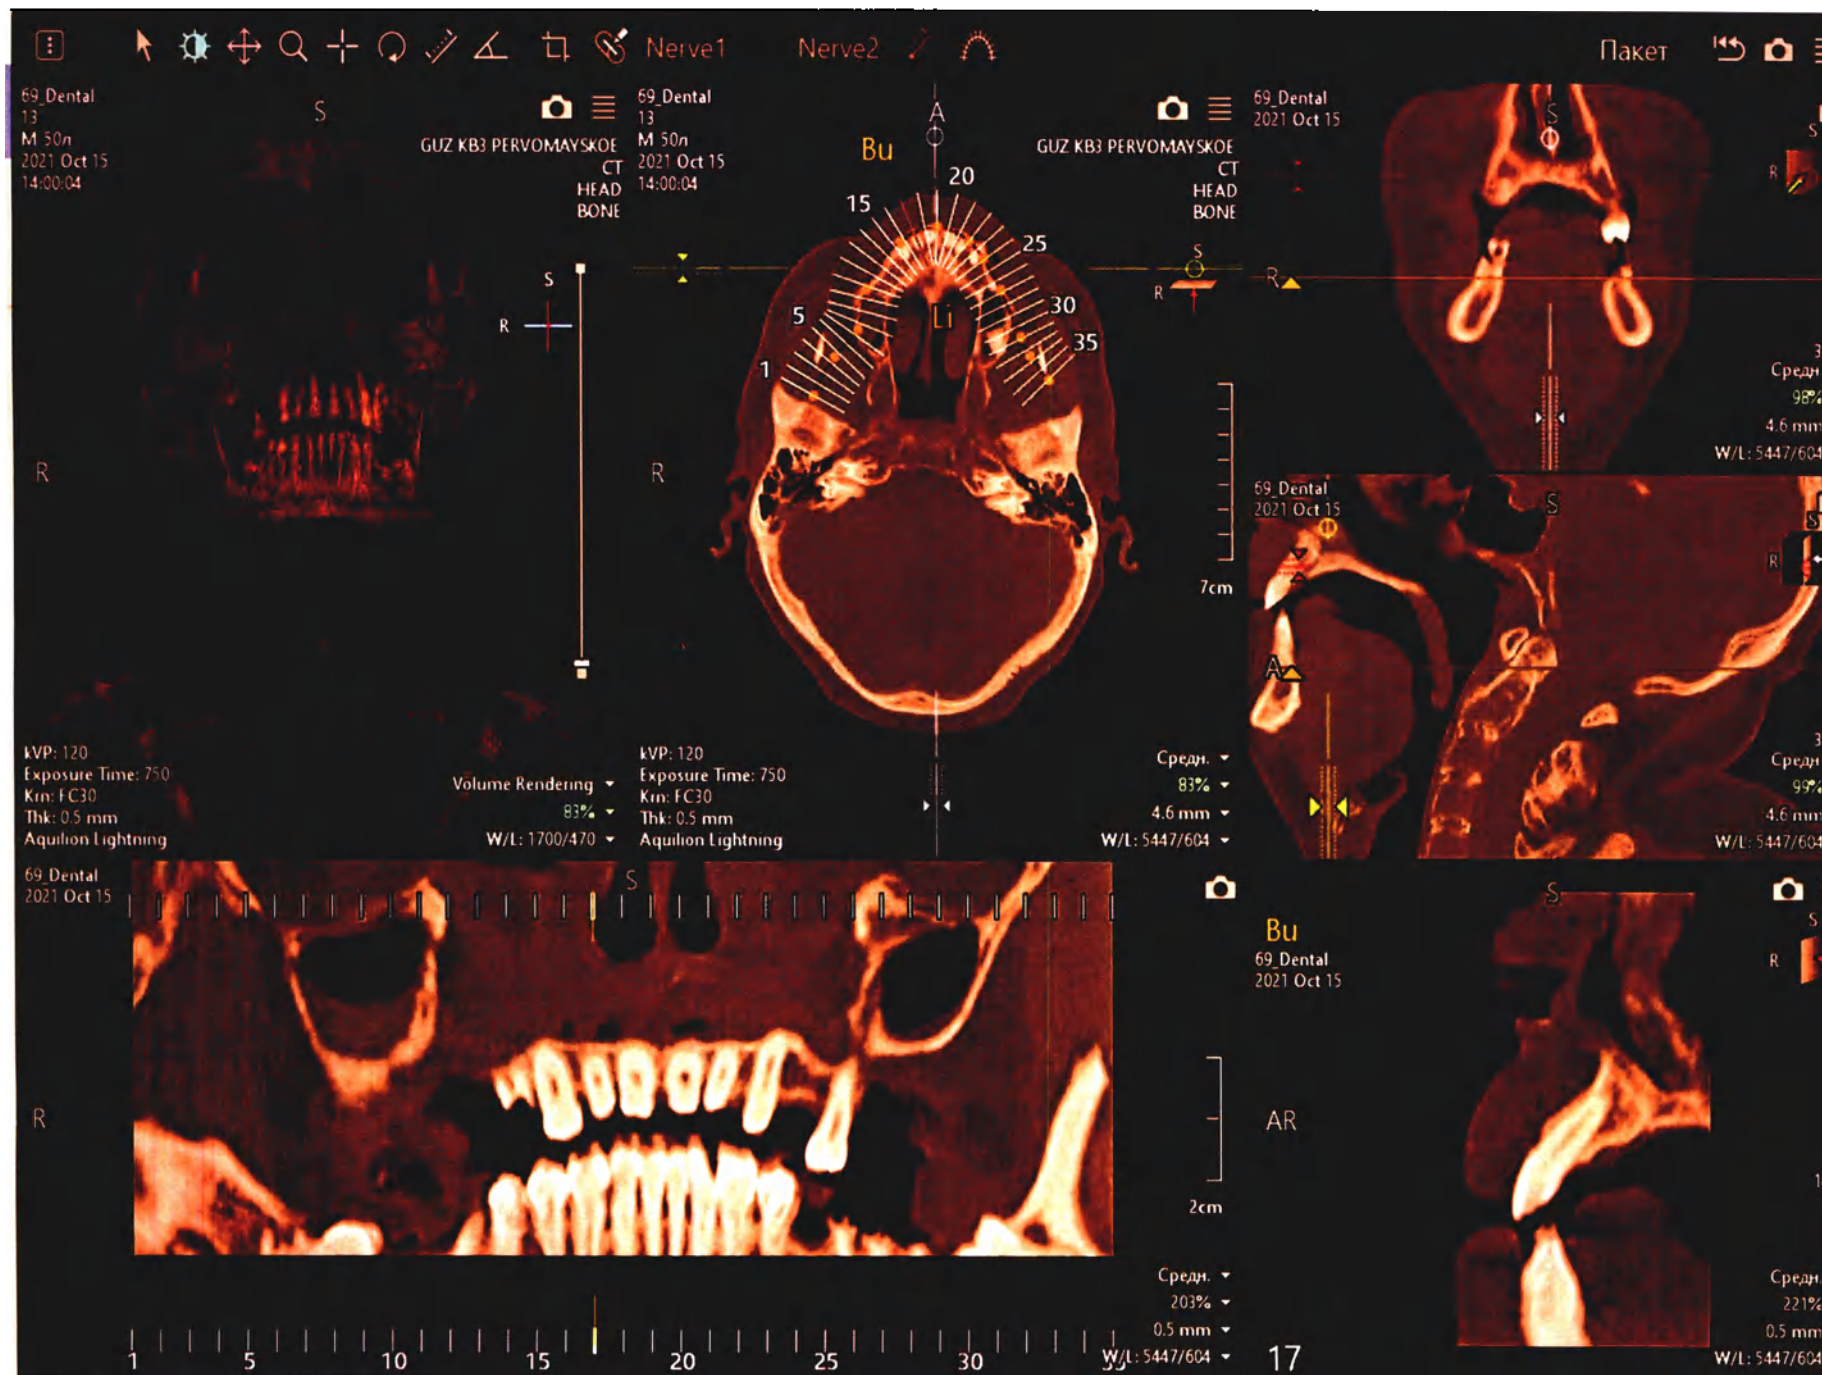


46. Приложение для оценки динамической перфузии миокарда (при необходимости).

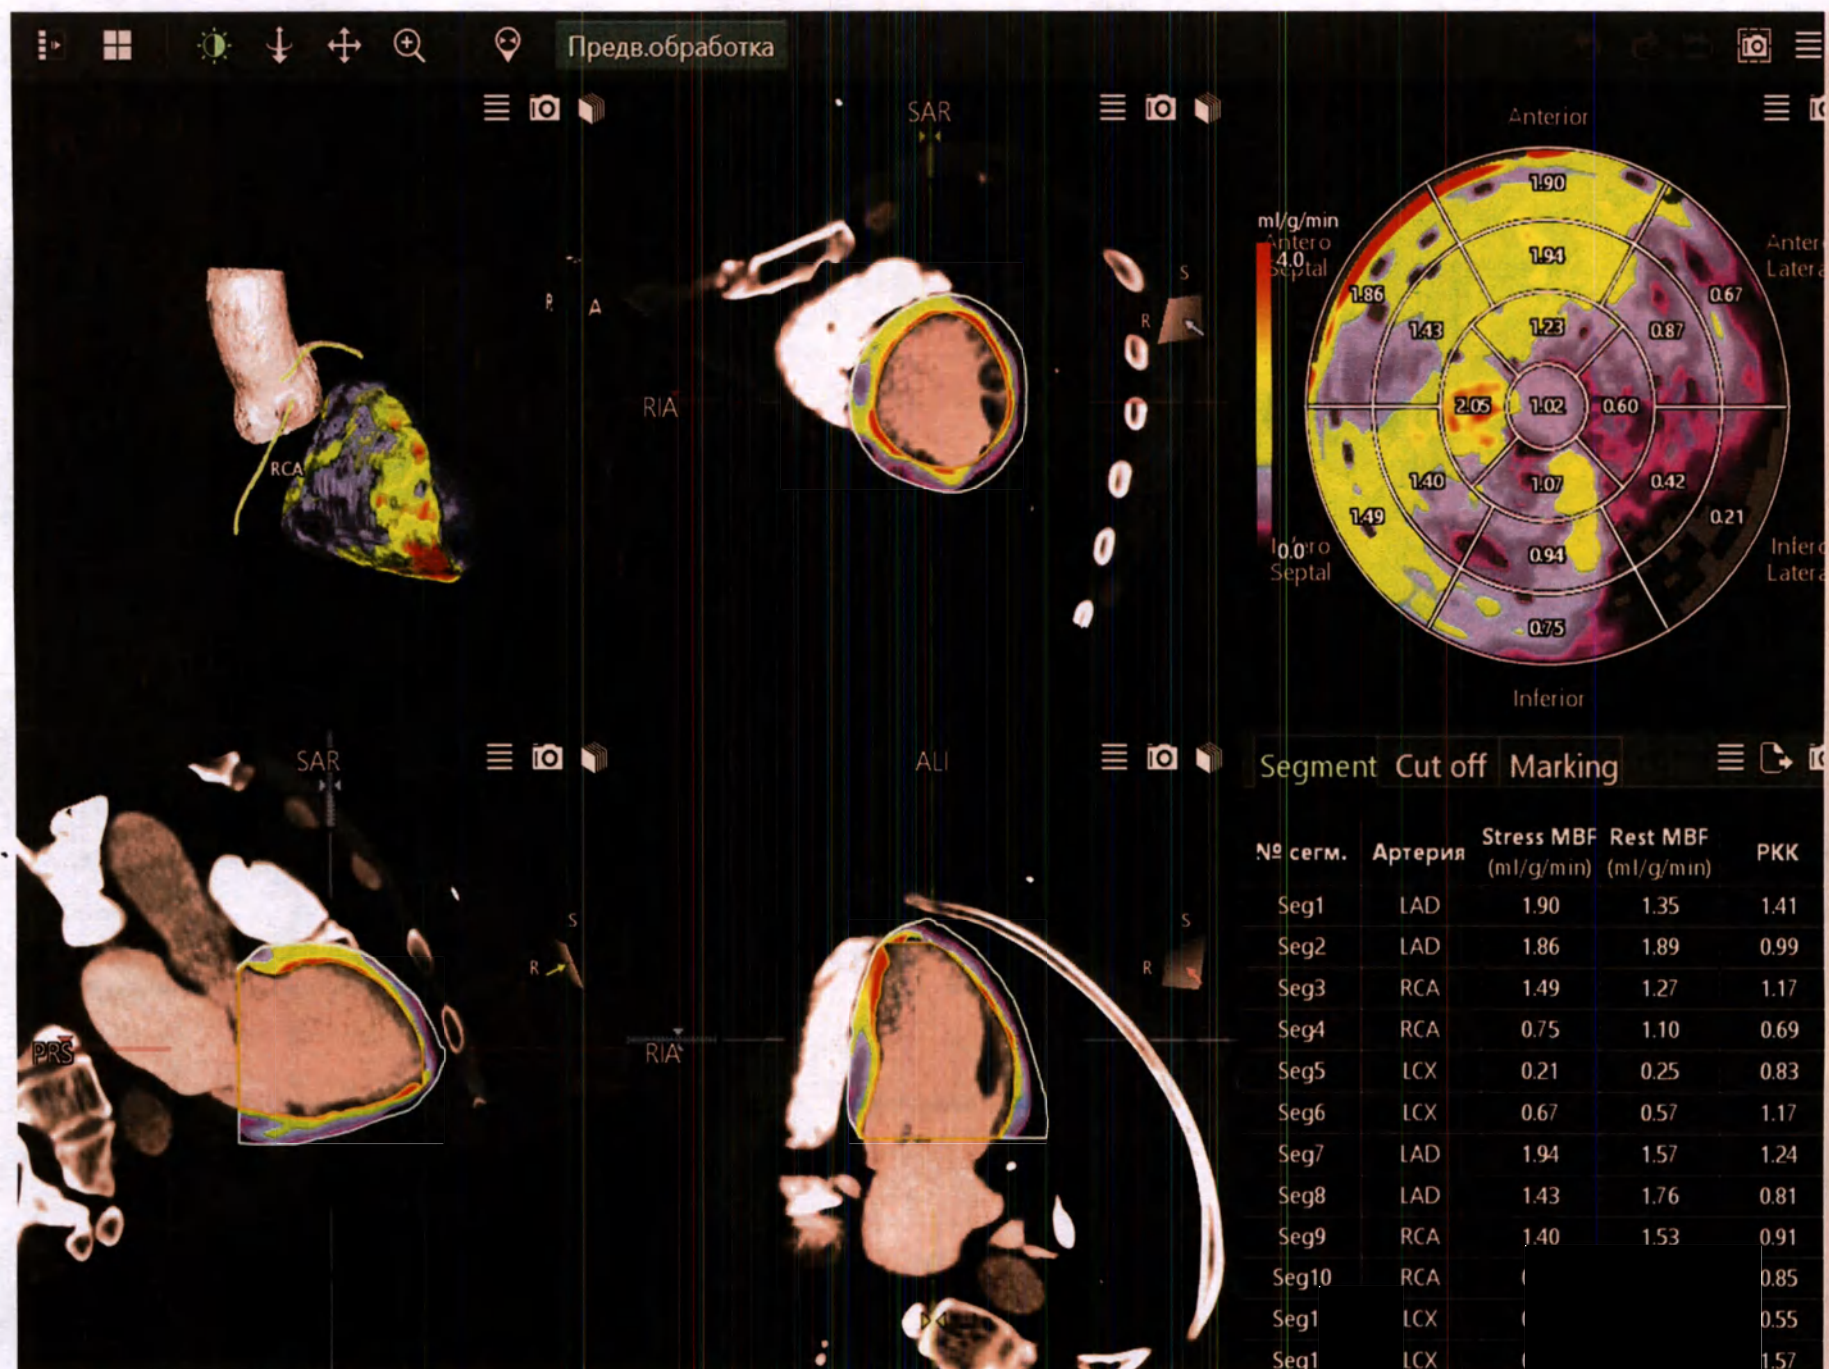


47. Приложение для анализа дыхательных путей (при необходимости)

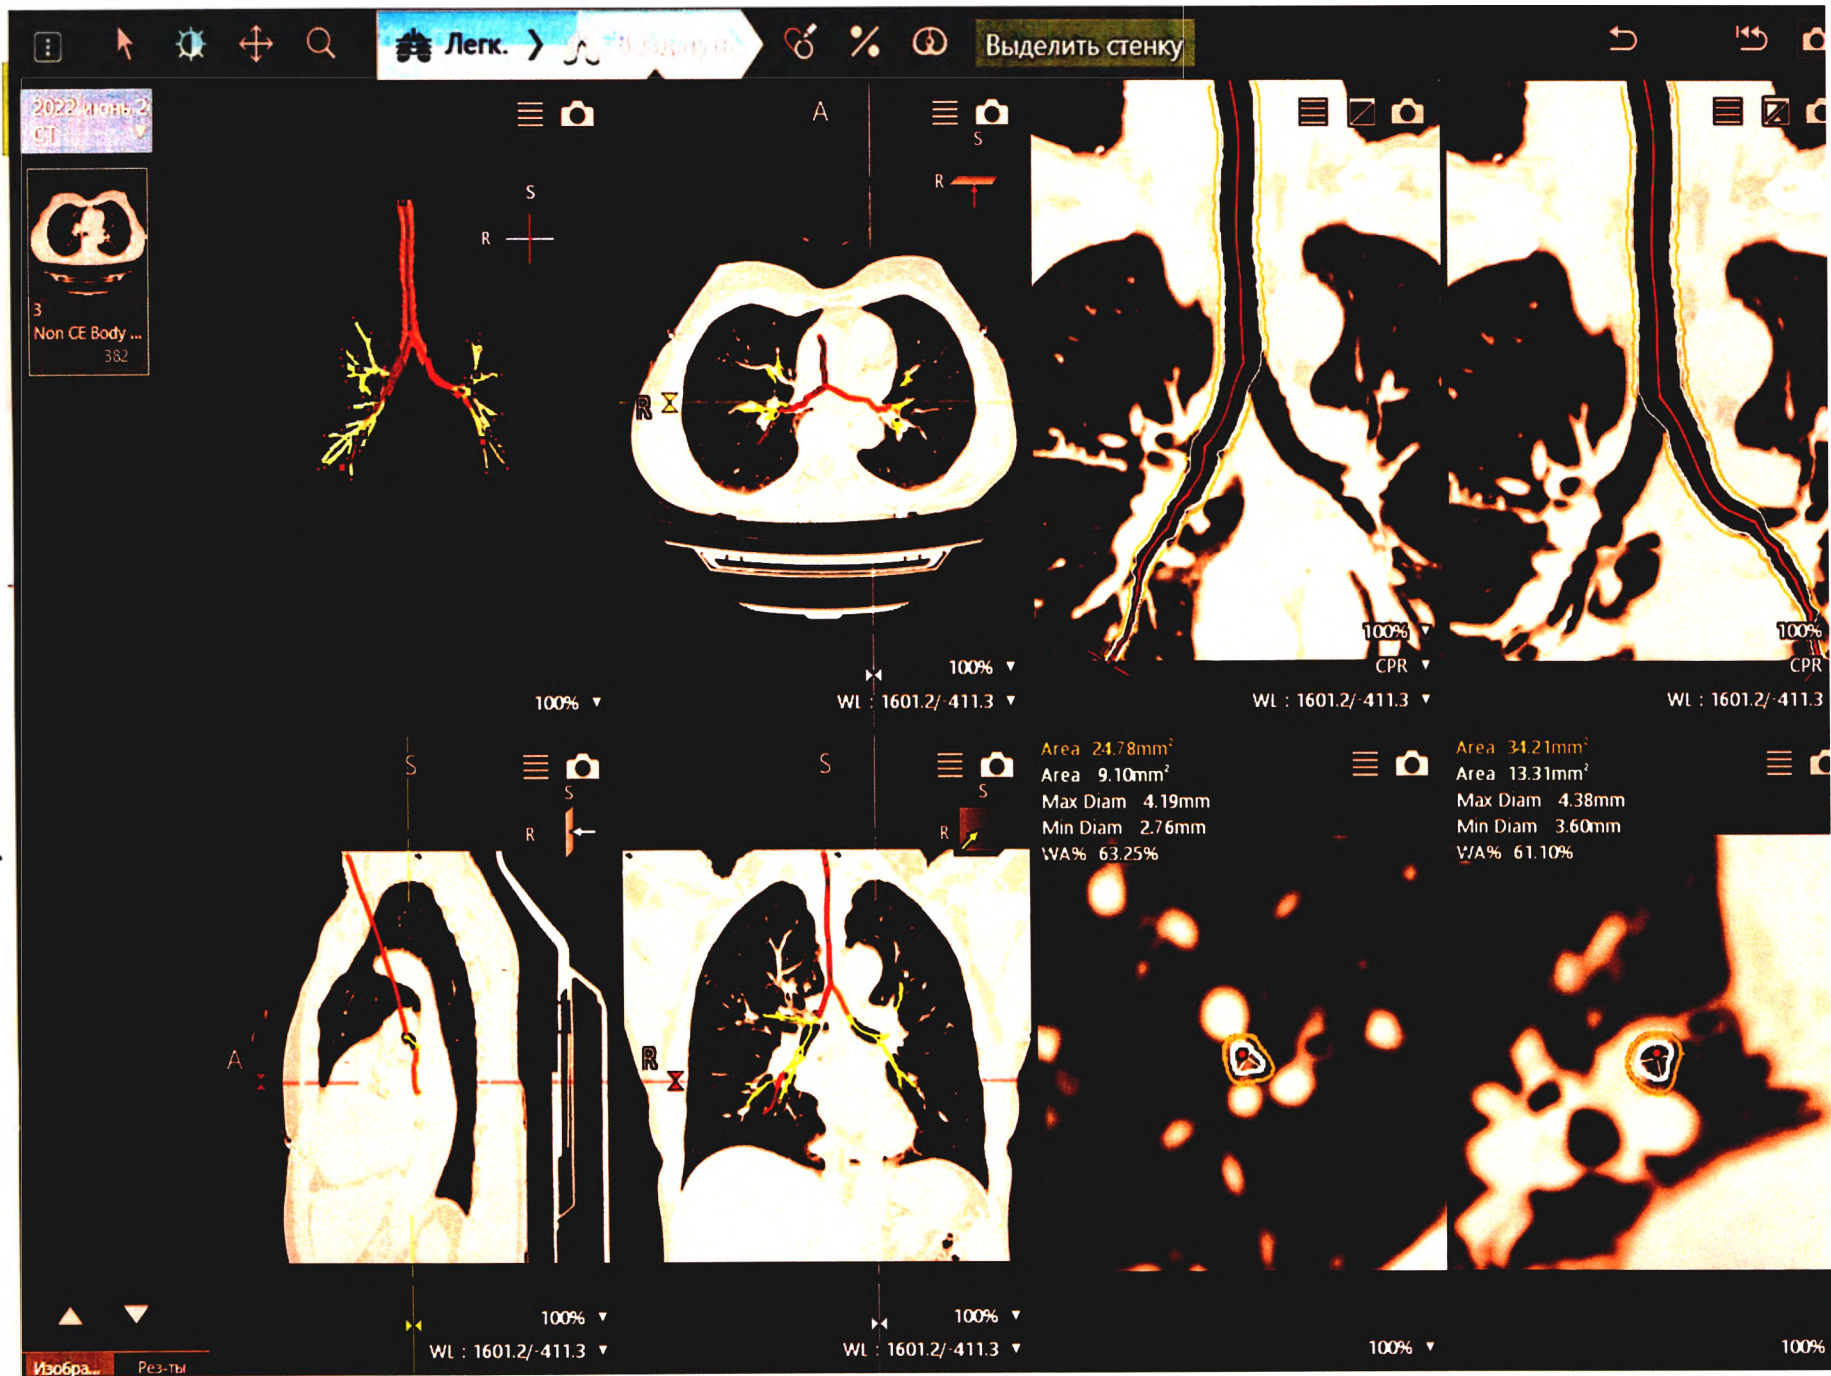


48. Приложение для улучшения качества изображений (при необходимости)

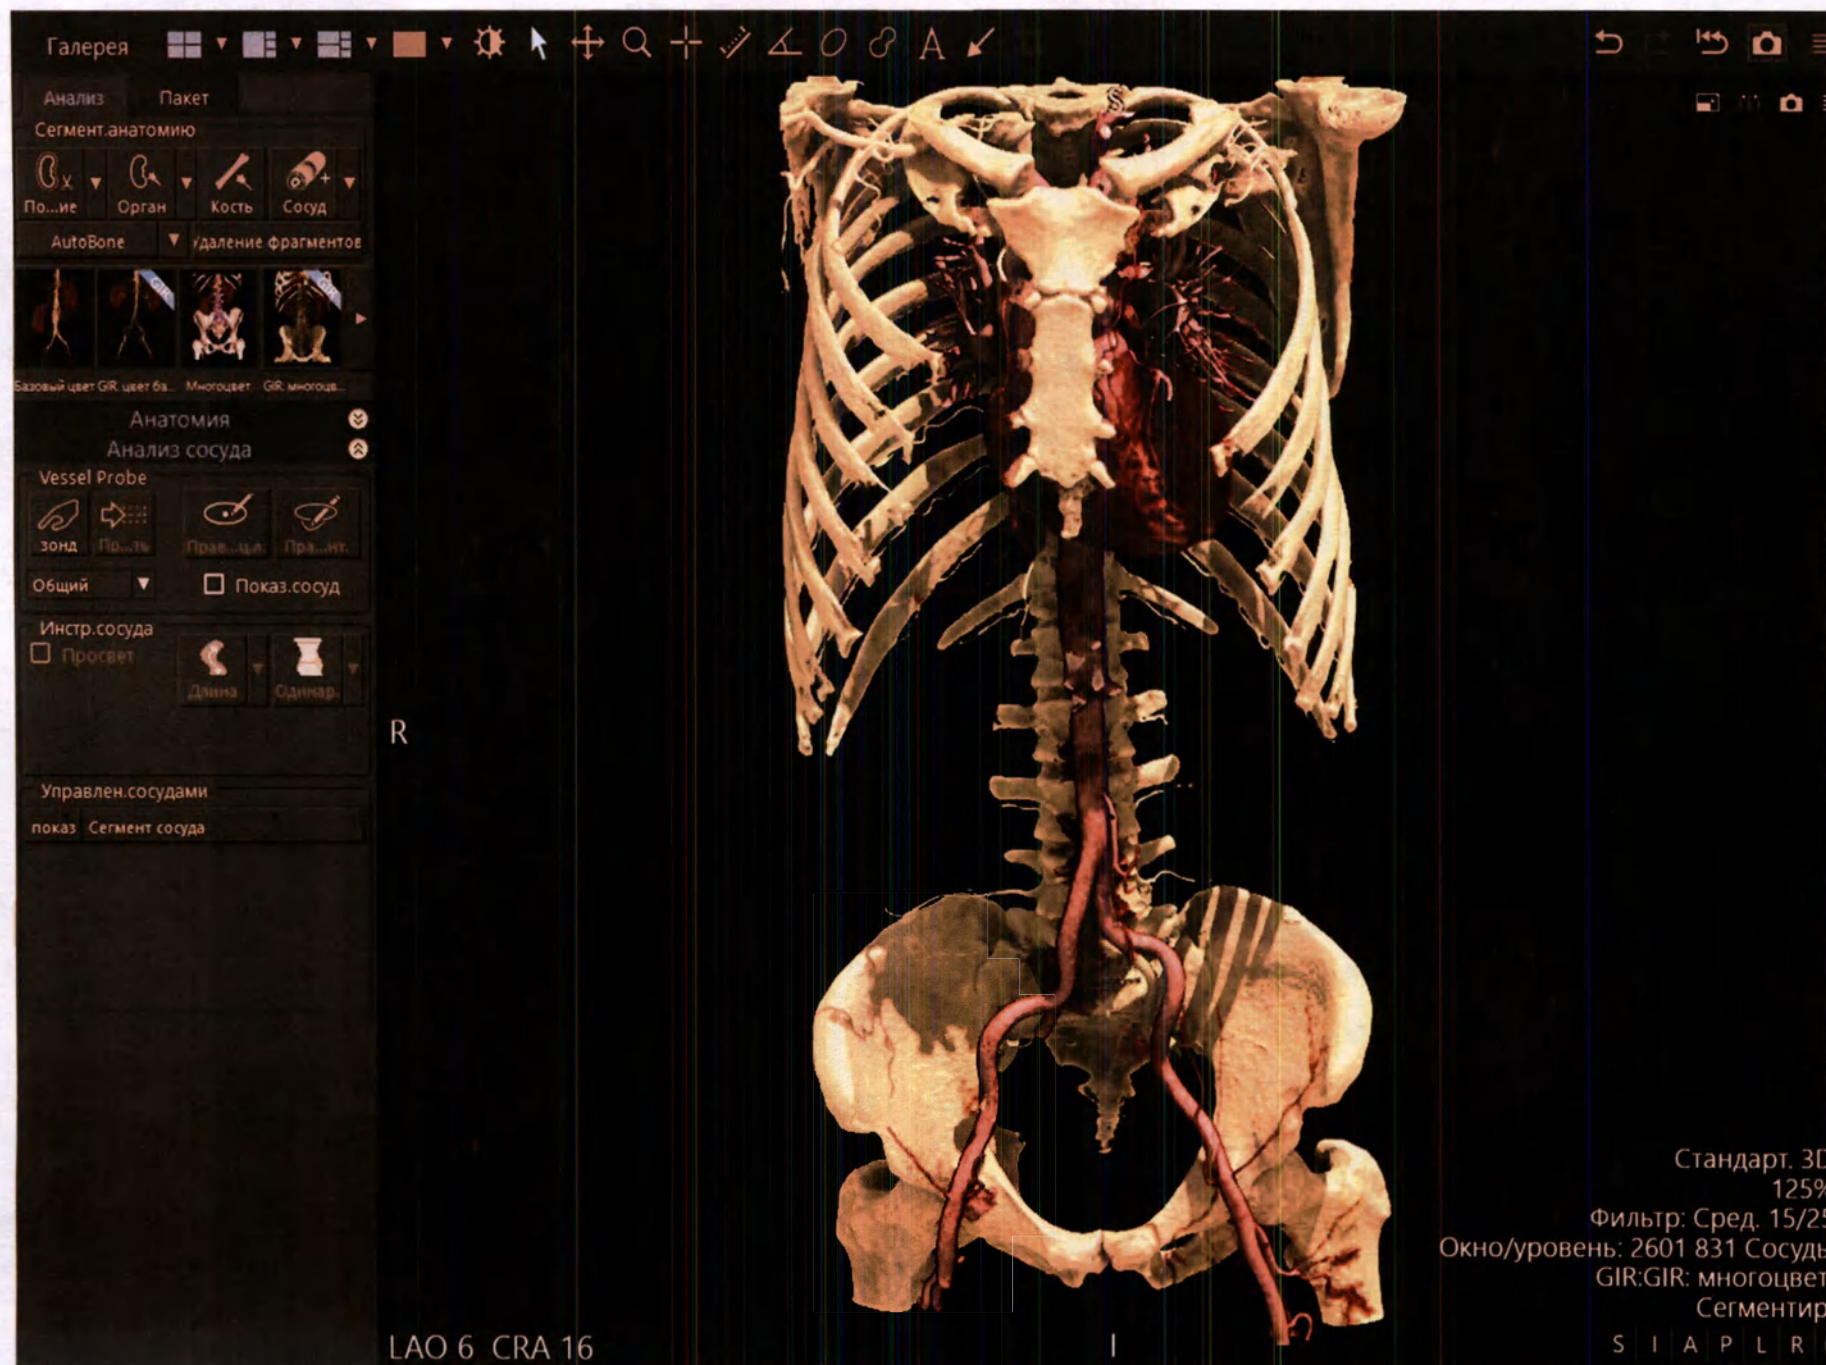

49. Приложение для совмещения изображений (при необходимости)

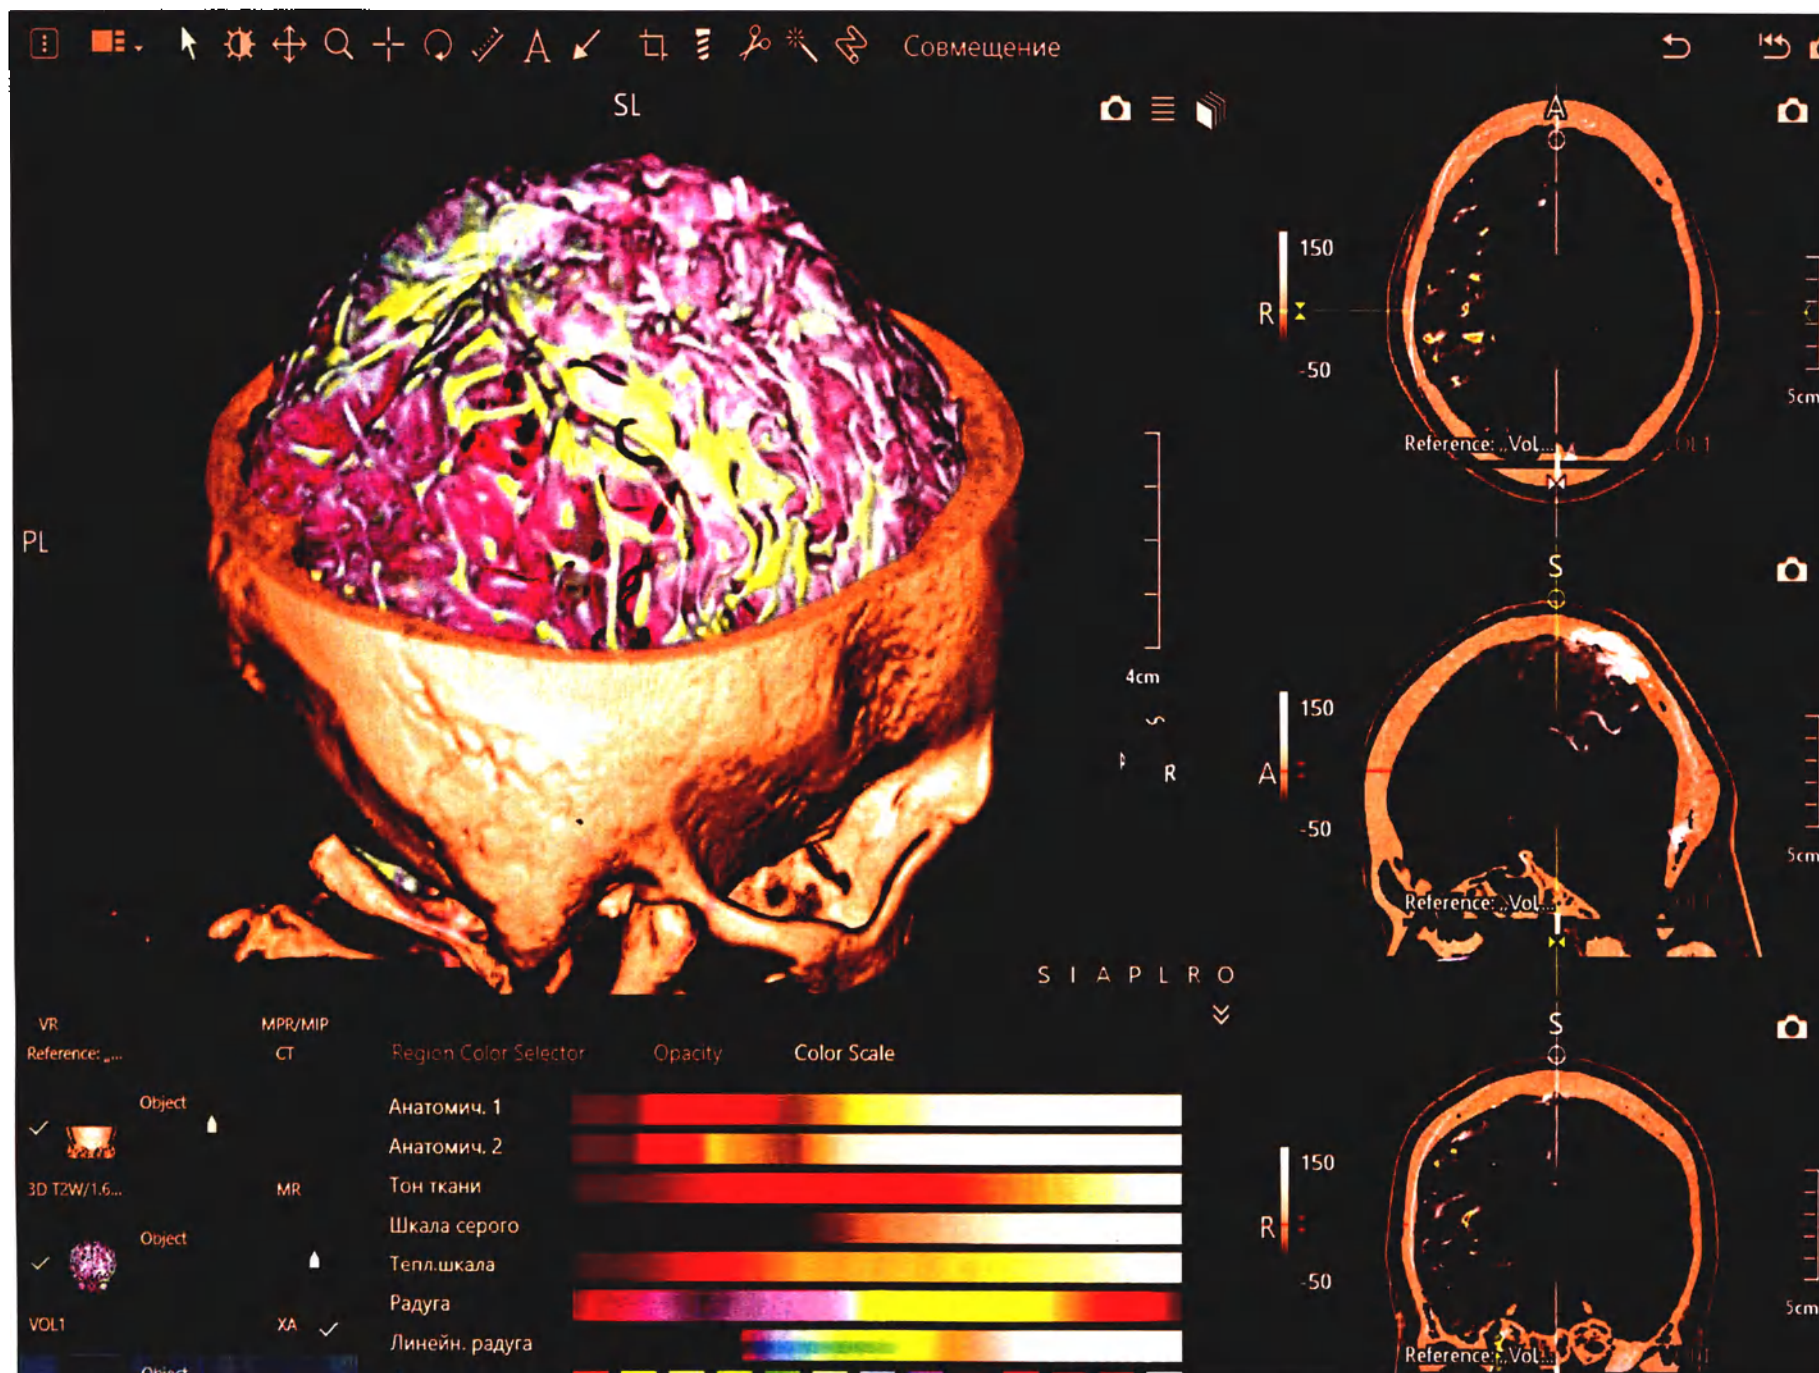

50. Приложение для обработки и анализа изображений для сердечно-сосудистой хирургии (при необходимости) (IMAGE-COM)

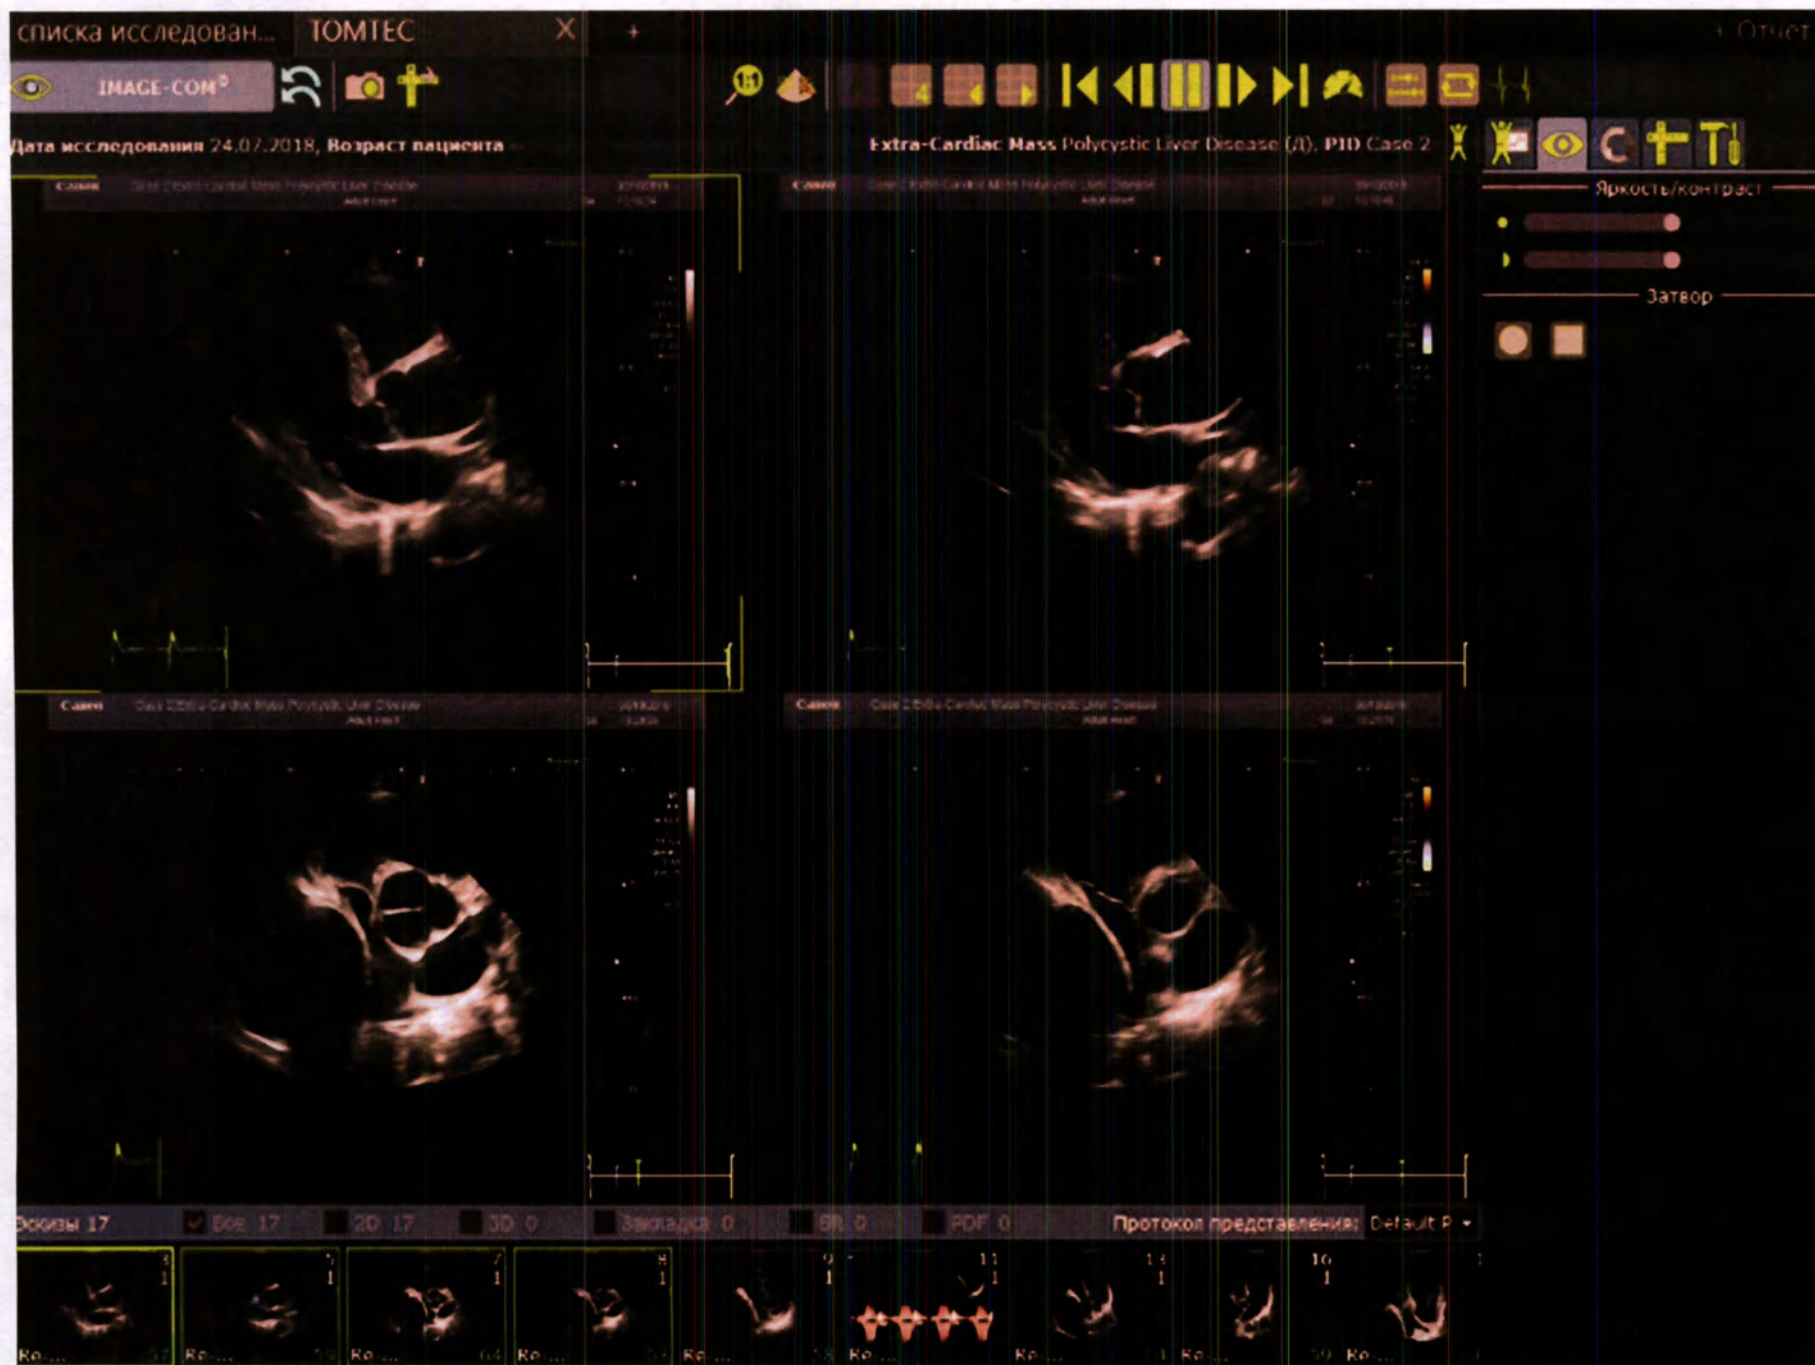

50. Приложение для обработки и анализа изображений для сердечно-сосудистой хирургии (при необходимости)
(Digital Subtraction Angiography)

списка исследований... TOMTEC X + + Отчет ?

IMAGE-COM®

Дата исследования... VL_MMV_Coronary Angio (13.11.1933, М), Текущий возраст 89 л, PID RSNA 2018

Метод калибровки: Изоцентр
Коэффициент калибровки: 0.199mm/px
RAO 30° / CAUD 32°

Уровень/окно
128
255

Гистограмма

Повышение резкости
0

Затвор

DSA

Маска по кадру
Сдвиг по пикселям
Уровень вычитания
0

Эскизы 3 ☒ Все 3 2D 1 3D 0 Зак 0 SR 2 PDF 0 ия: []

310000
3
100

DCM
SR
1
7

DCM
SR
2
7

37/100
-15 fps

Текущий пользователь:

TOMTEC

50. Приложение для обработки и анализа изображений для сердечно-сосудистой хирургии (при необходимости) (Cath-QCA)

Дата исследования 16.09.2013, Возраст пациента 79 л

LAD

Reference diam	1,52 mm
Lesion diam	0,80 mm
Stenosis (diam)	47,2 %
Stenosis (area)	72,1 %
Lesion length	4,11 mm



Метод калибровки: Изоцентр
Коэффициент калибровки: 0.162mm/px
RAO 33° / CRAN 39°

50. Приложение для обработки и анализа изображений для сердечно-сосудистой хирургии (при необходимости) (Cath-QLVA)

Study Date 08/14/2013, Patient's Age 55 y

Biplane

Volume

EDV (AL RAO 30)	104.34 ml
ESV (AL RAO 30)	34.82 ml
SV (AL RAO 30)	69.52 ml
EF (AL RAO 30)	66.6 %
EDV (MOD RAO 30)	106.84 ml
ESV (MOD RAO 30)	31.92 ml
SV (MOD RAO 30)	74.92 ml
EF (MOD RAO 30)	70.1 %

1 EDV (RAO 30)

2 ESV (RAO 30)

Calibration method: Catheter
Calibration factor: 0.300mm/px


Fr 51

Ca 6 French


Val 10%

RAO 30° / 0° | BIP A


51. Приложение для анализа рёбер и позвонков (при необходимости)

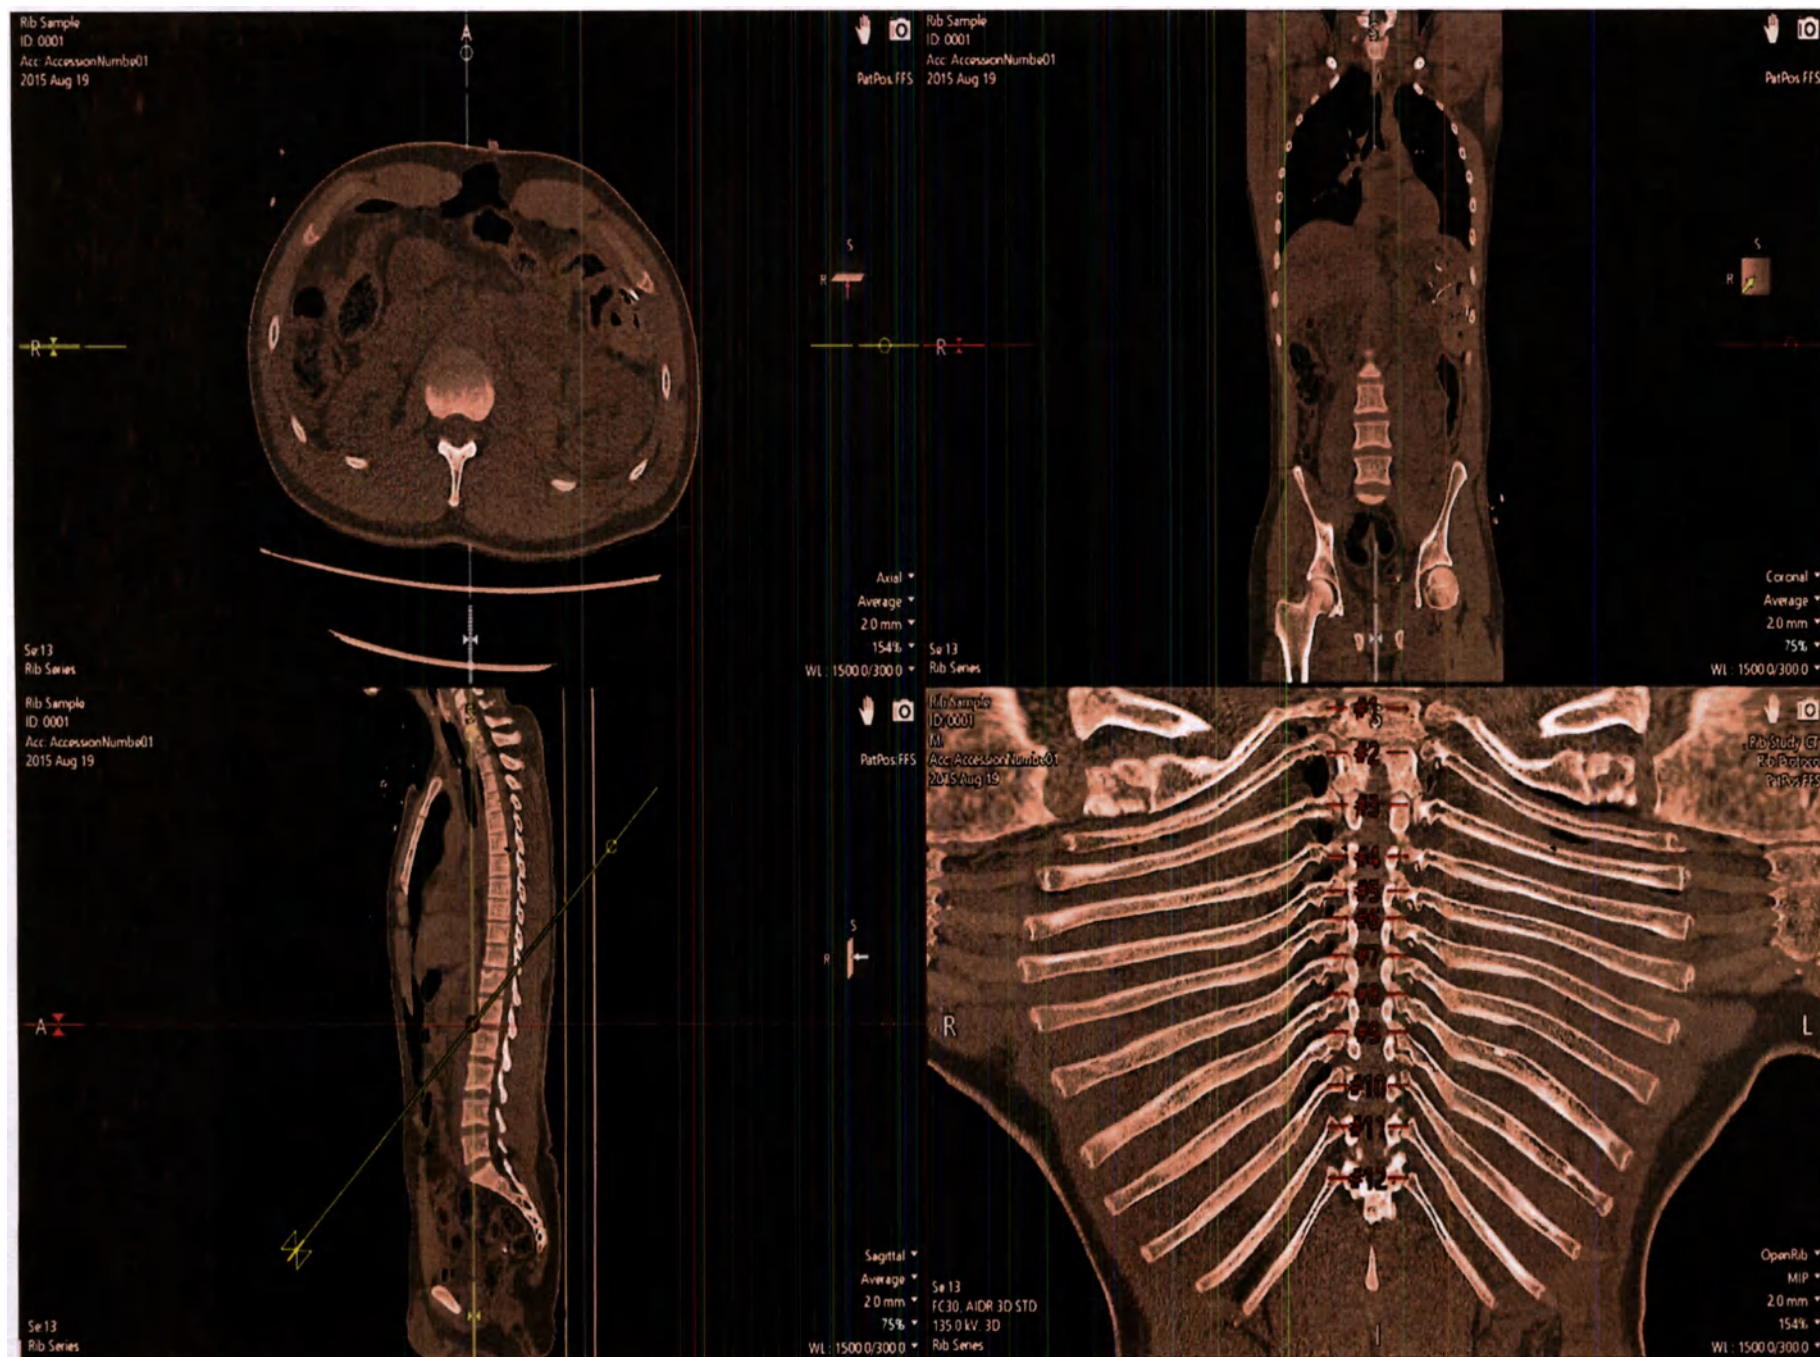


52. Приложение для анализа субтракционных изображений (при необходимости)

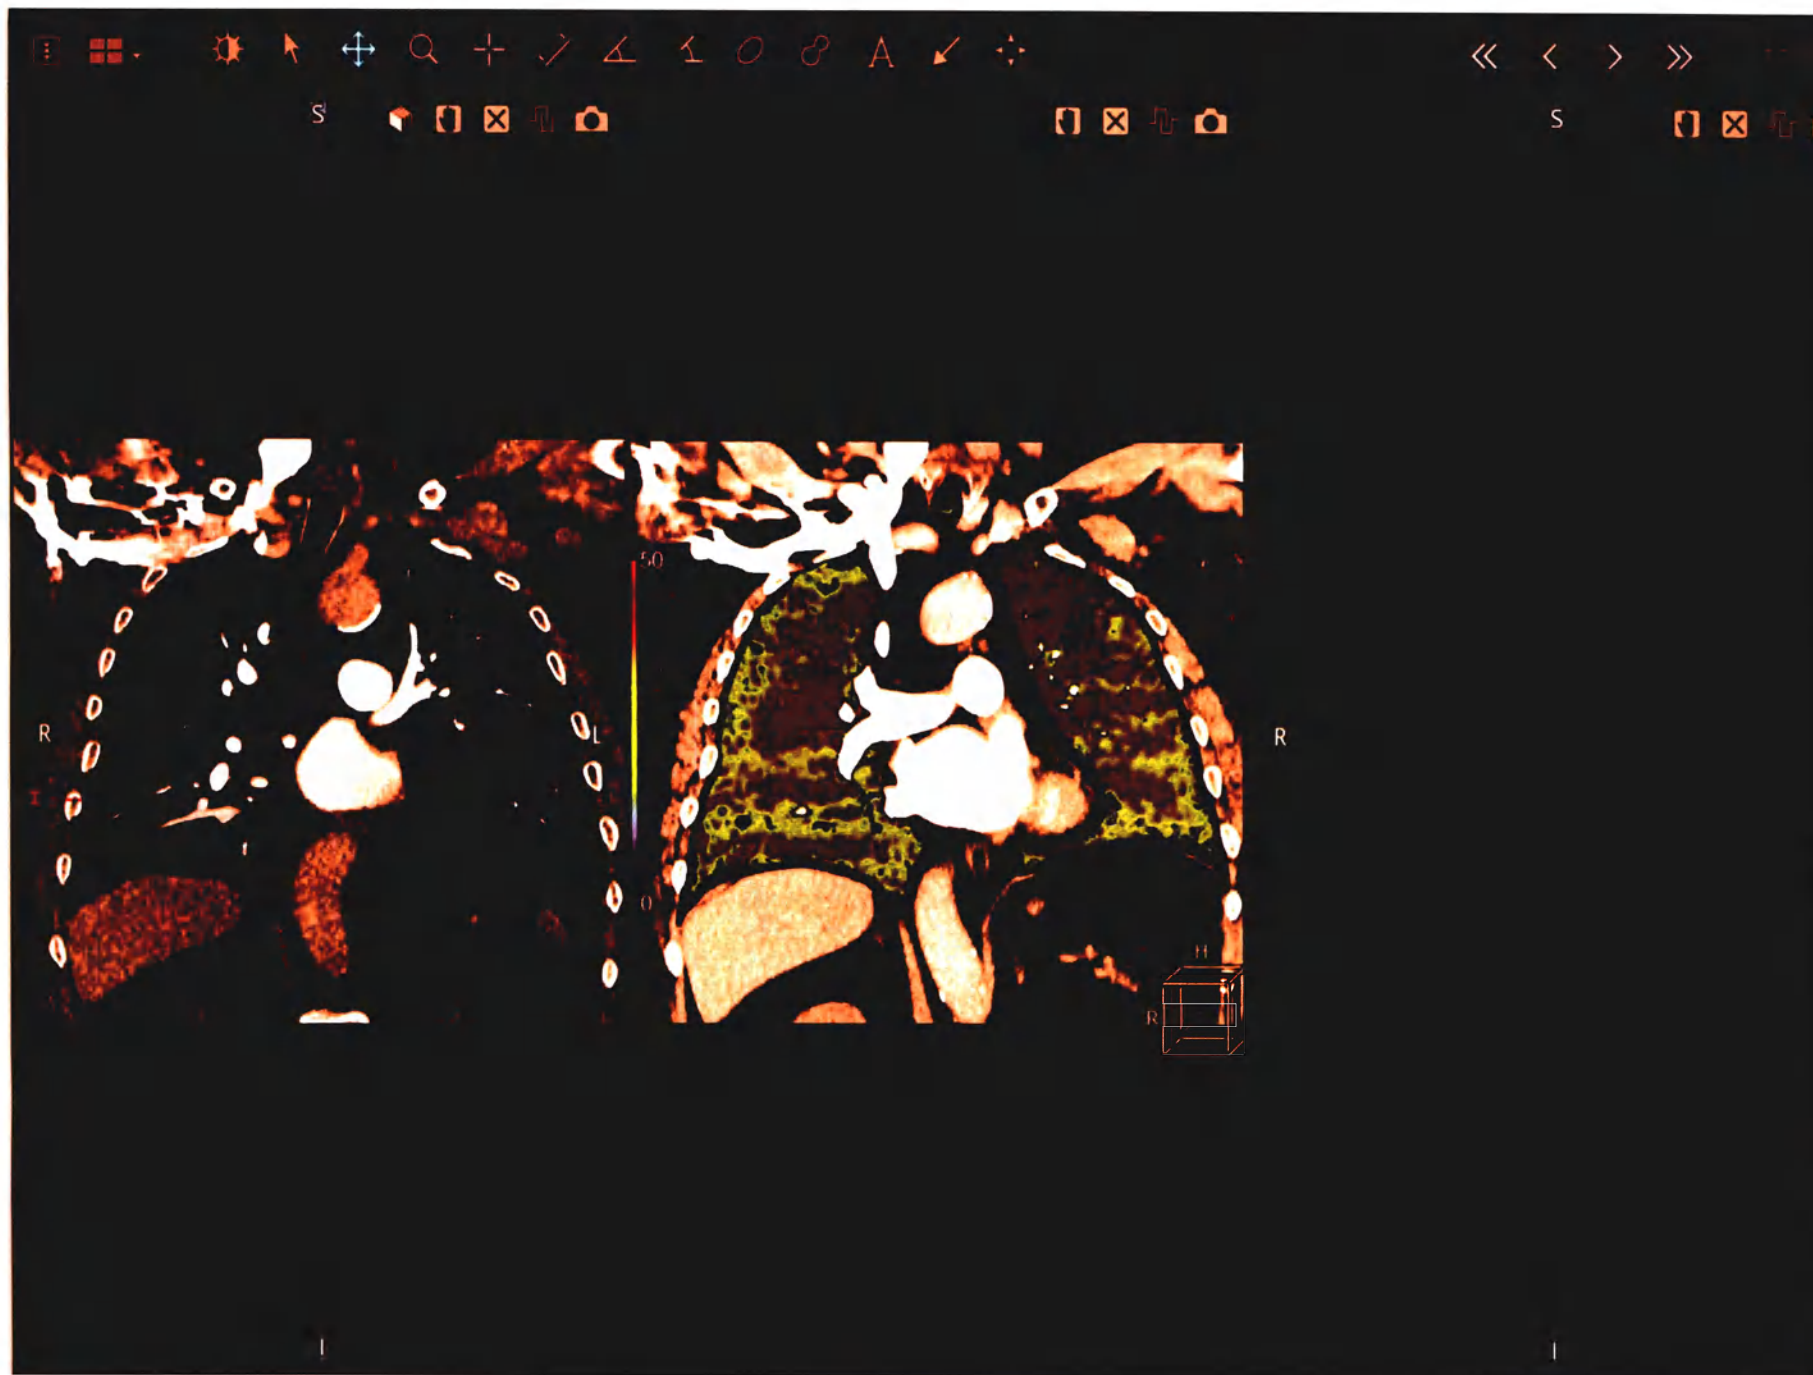


53. Сервер управления данными марки DEPO (модель DEPO Storm 3450A2), производства ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС», Россия, не более 100 шт. (при необходимости)

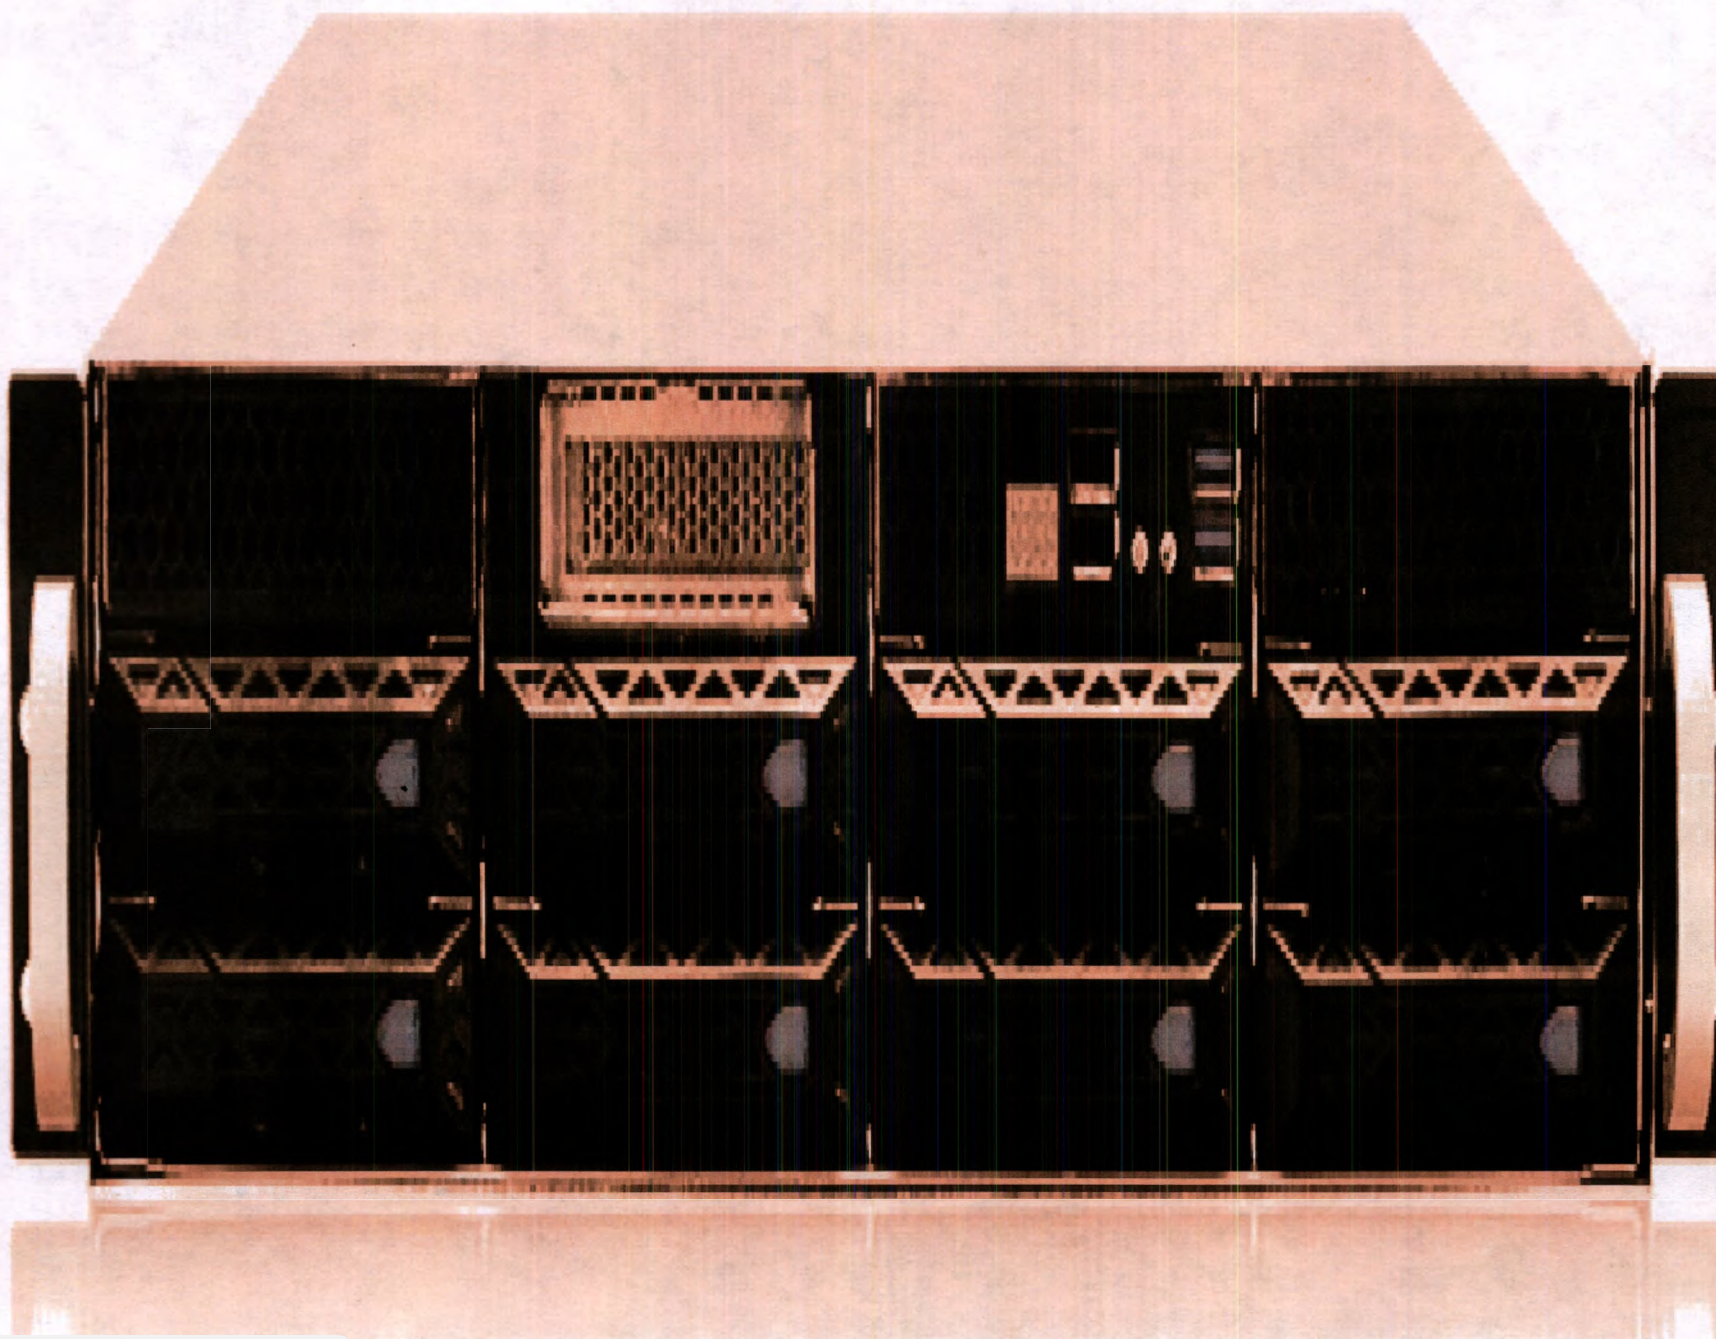

54. Сервер обработки изображений марки ДЕПО (модель ДЕПО Race GX255 или модель ДЕПО Storm 3470G2X), производства ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС», Россия, не более 100 шт. (при необходимости)

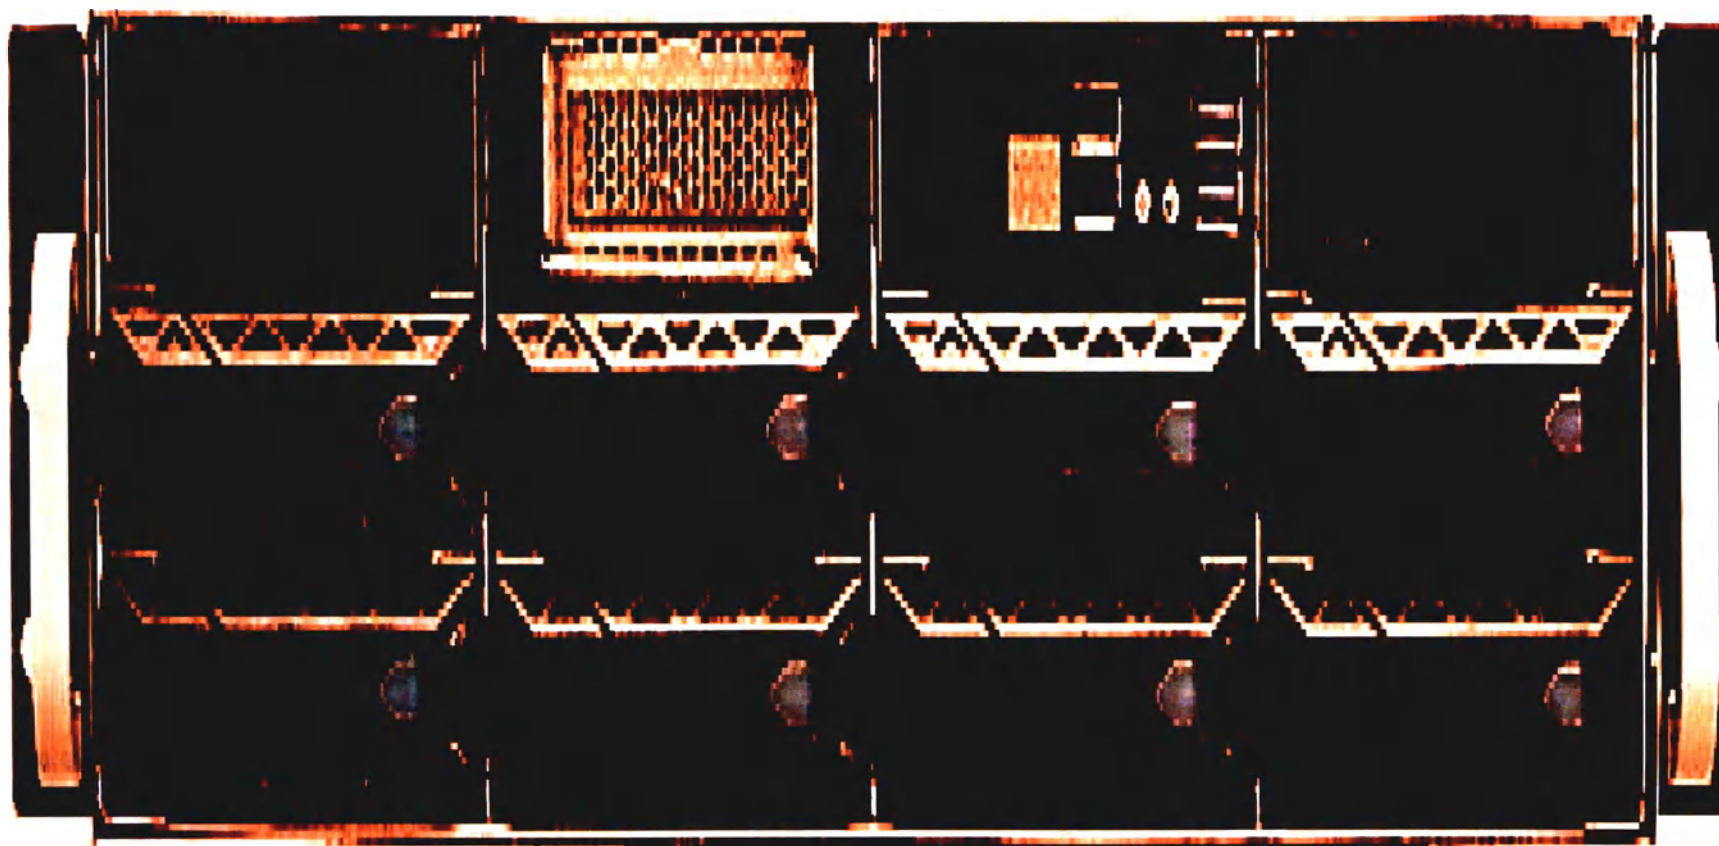


55. Блок системный марки HP (модель HP Z4 G4), производства HP Inc., США, не более 100 шт. (при необходимости)

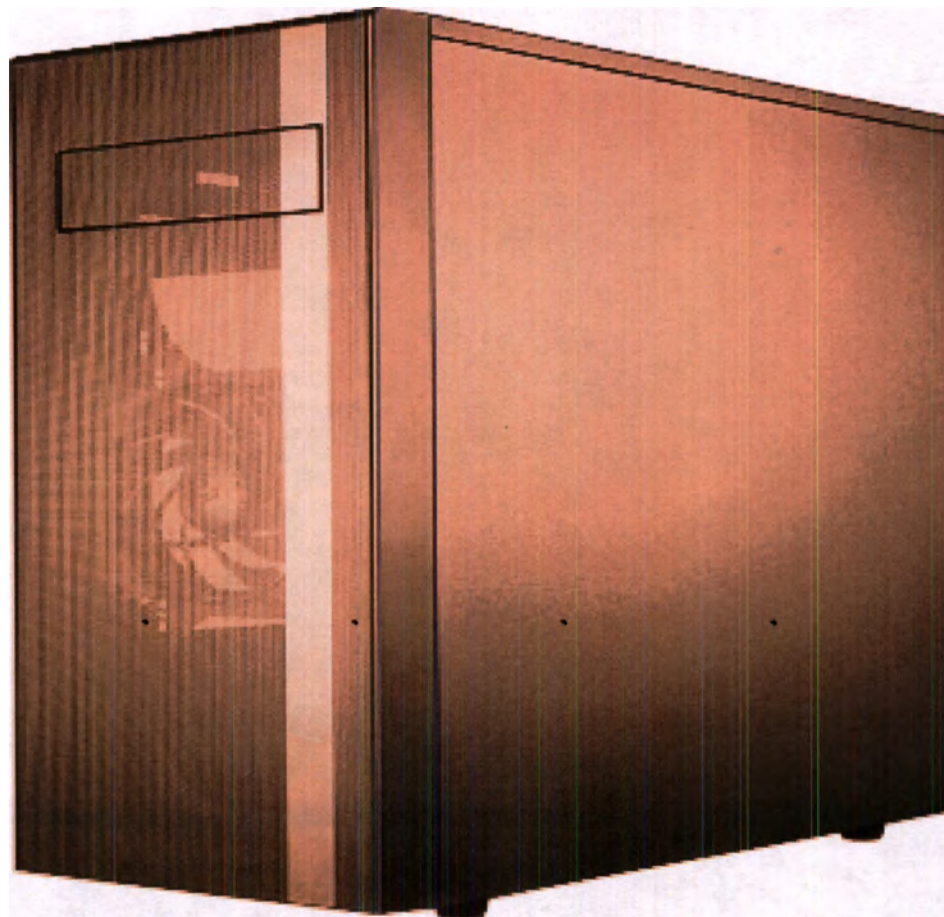

56. Монитор марки HP (модель HP z24i), производства HP Inc., США, не более 100 шт. (при необходимости)



57. Мышь компьютерная, не более 100 шт. (при необходимости)

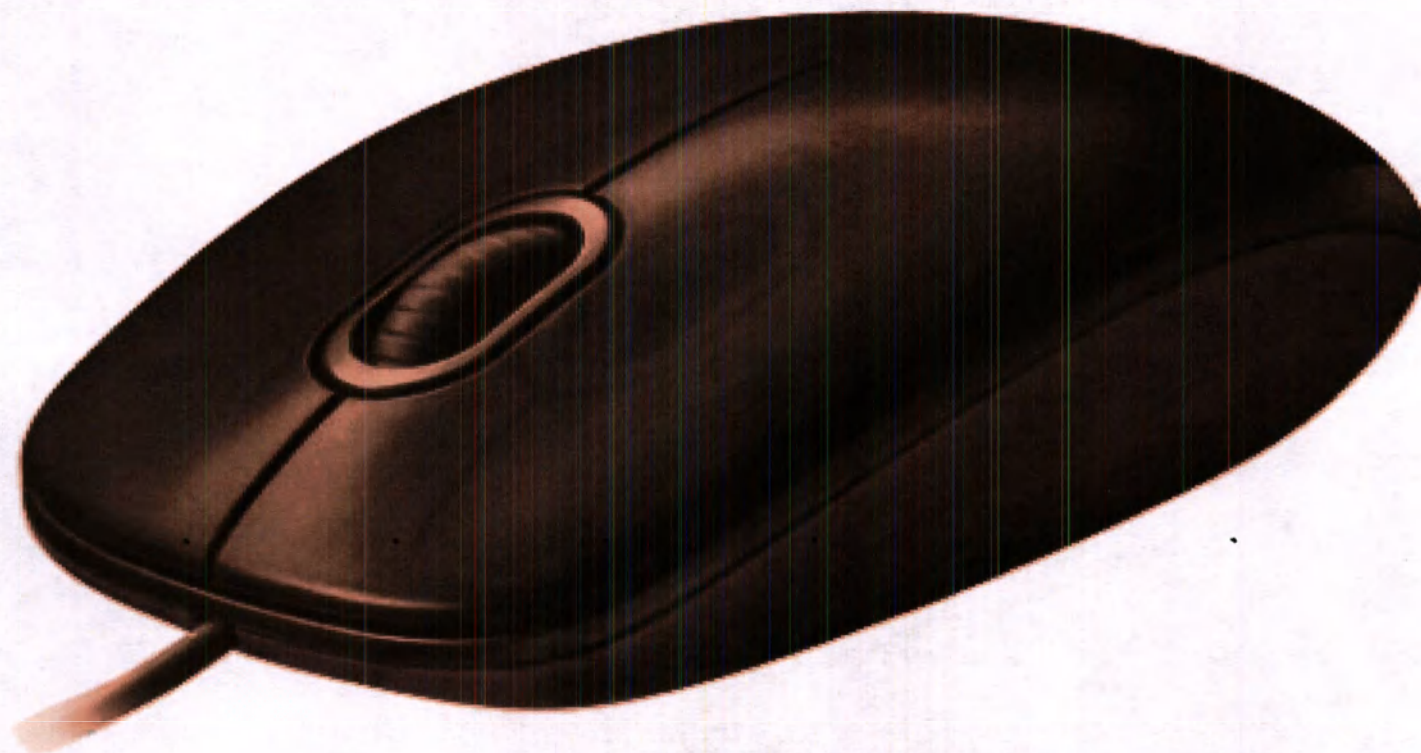


58. Клавиатура, не более 100 шт. (при необходимости)



Решение Extend

Три пользователя
одновременно

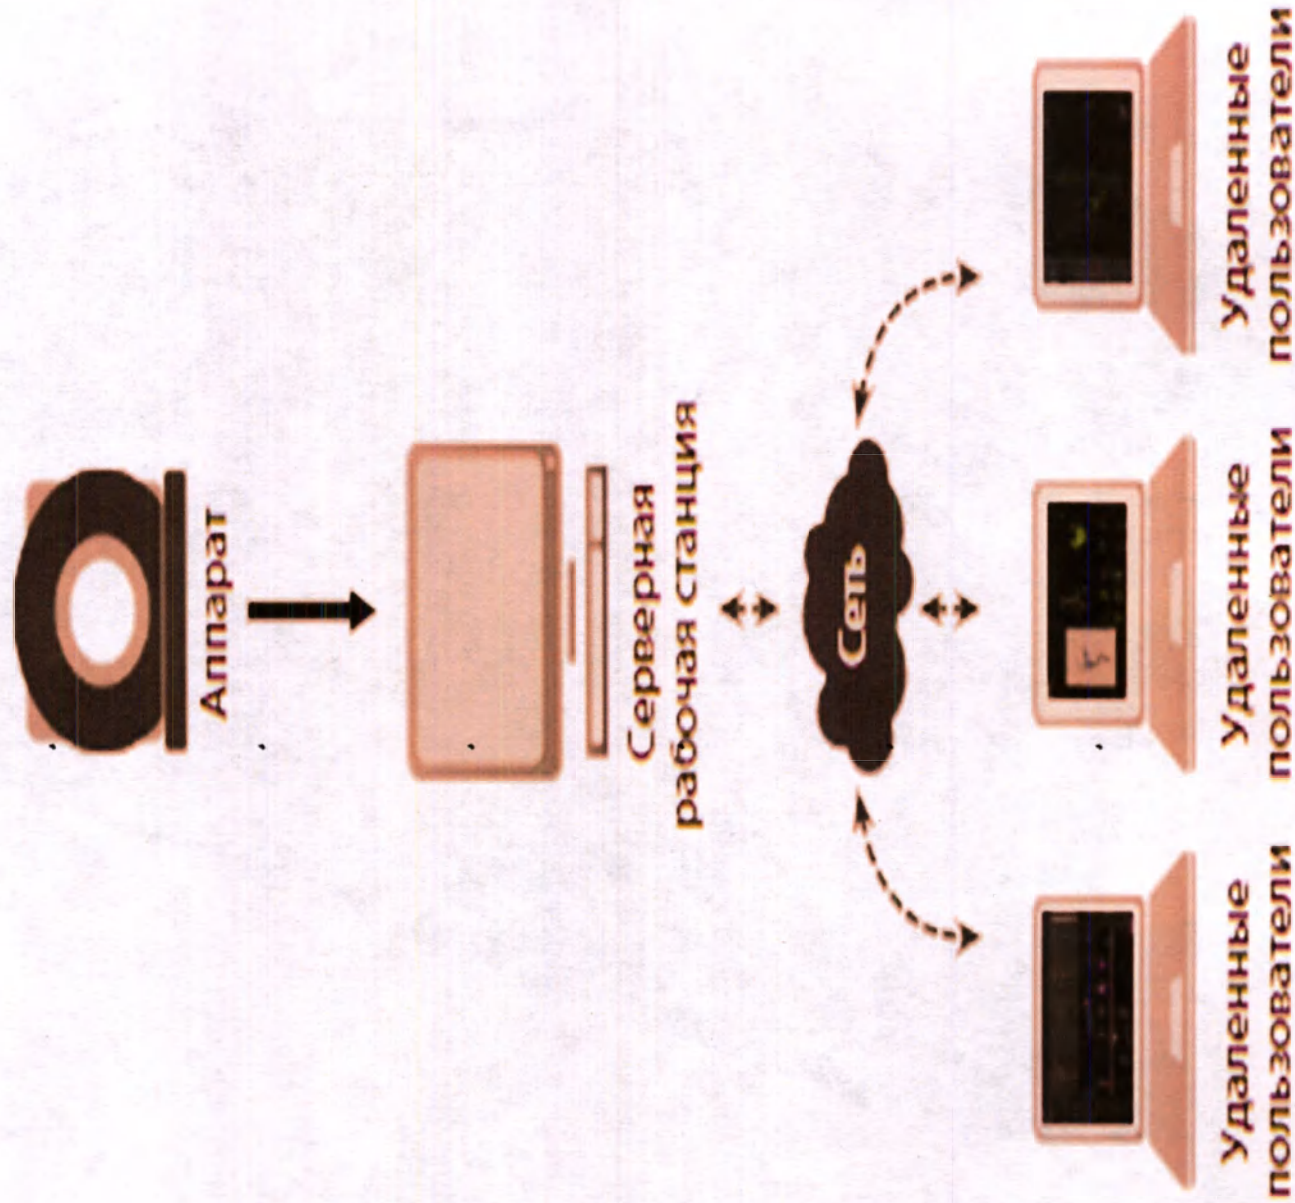

Принадлежности.

1. Лицензия для расширенной версии основного программного обеспечения Vitrea, не более 100 шт.

Решение Enterprise

Решение
для отделения

Шесть пользователей
одновременно



Решение для
всего учреждения

До 30 пользователей
одновременно










6. Лицензия для расширения функционала приложения МР-анализа молочных желез до функционала приложения для характеристики тканей молочных желез и последующего наблюдения

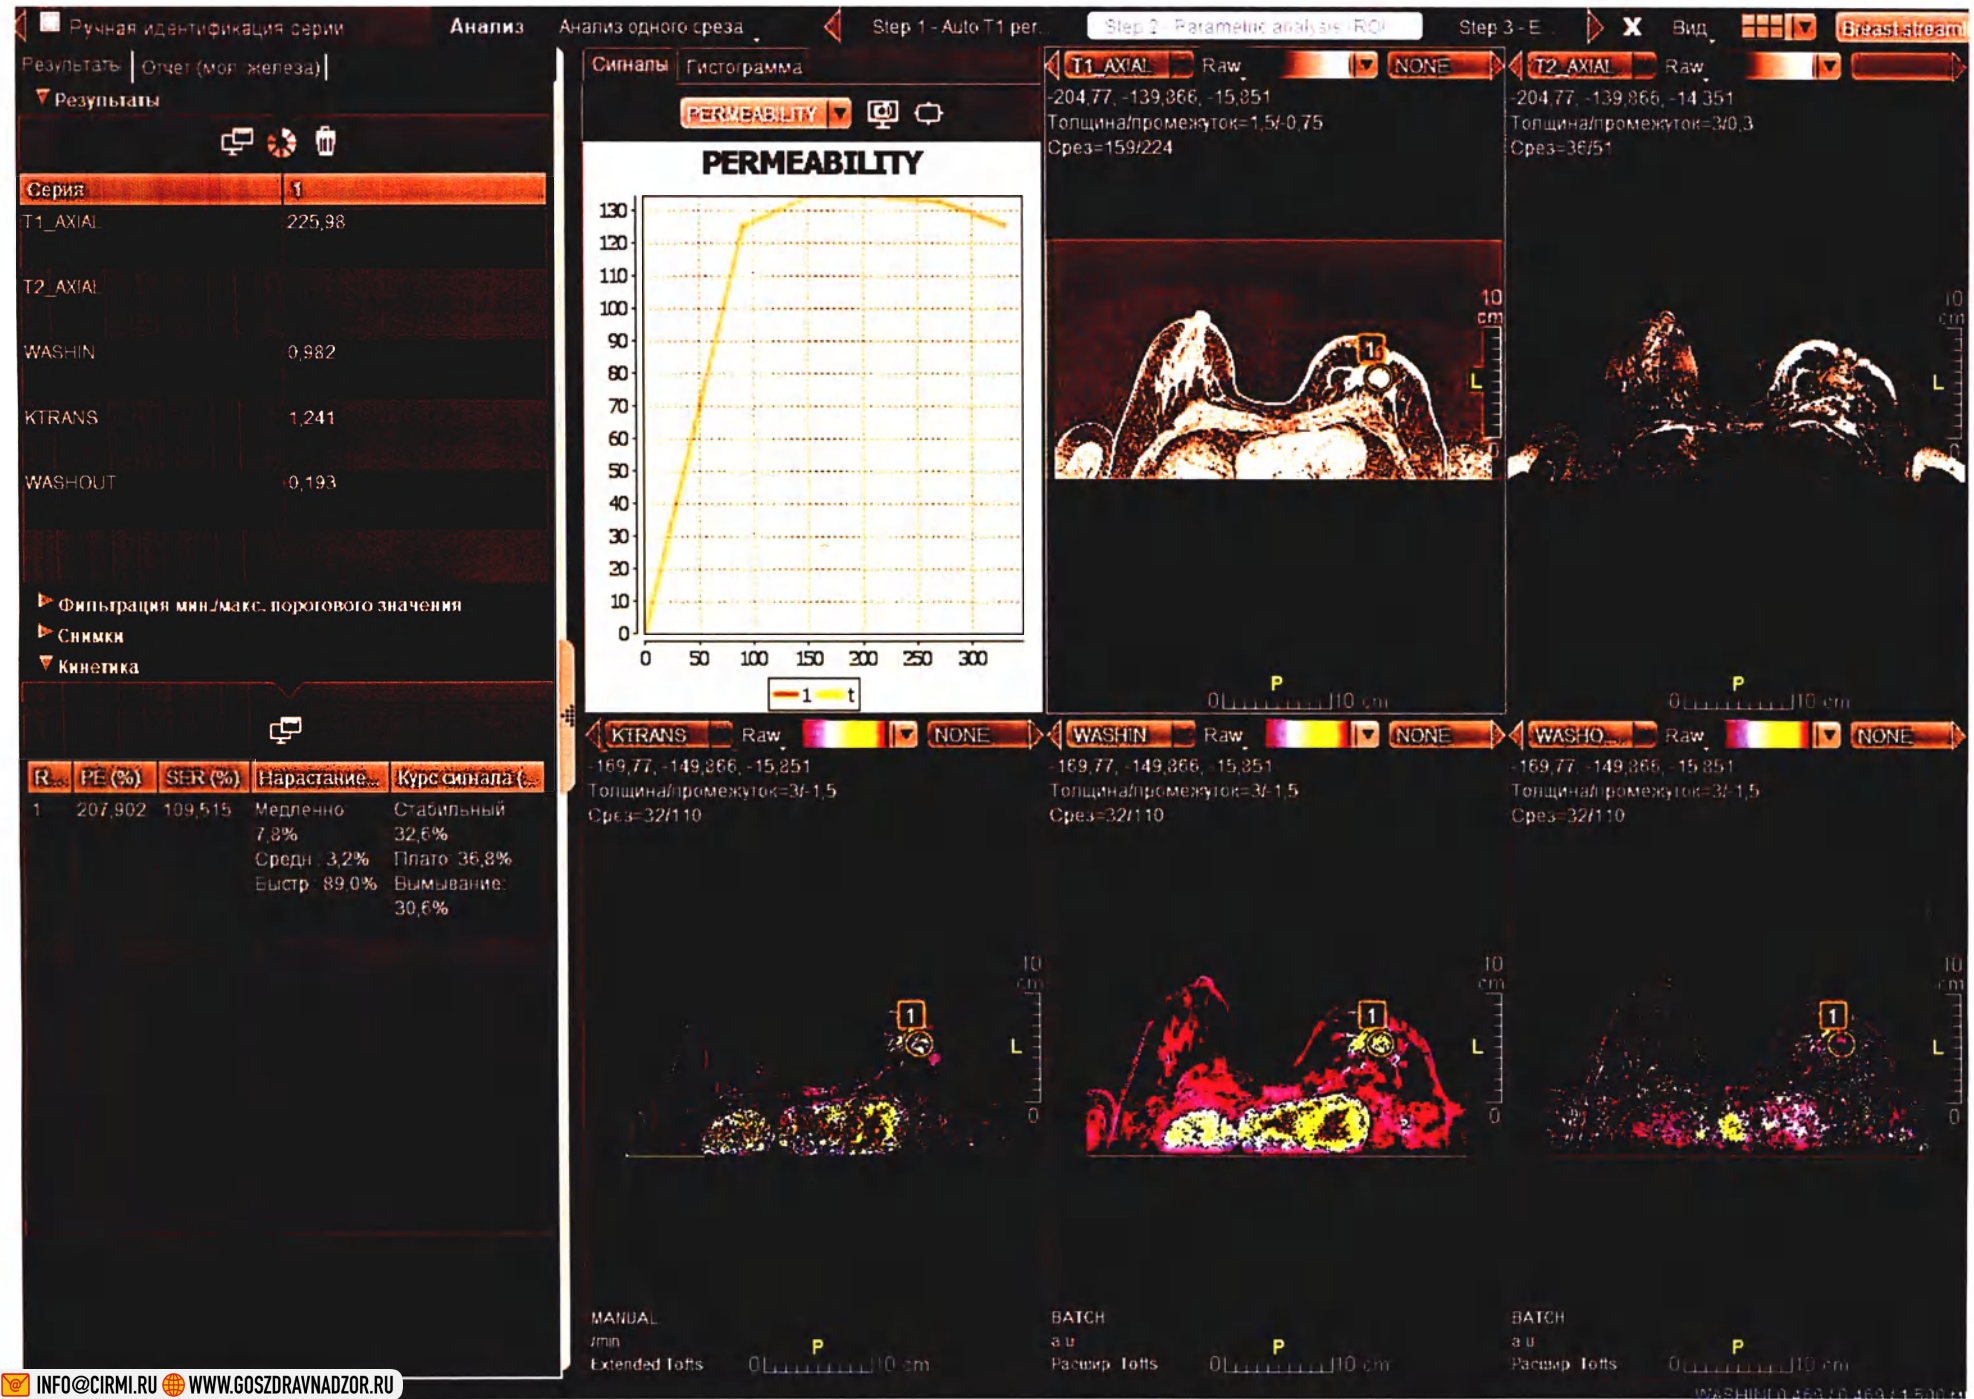

7. Лицензия для обновления версии основного программного обеспечения Vitrea, не более 100 шт.

VitreA-Admin

списка исследований...

Поиск: default PACS

Фильтр по:

Учреждение: (выберите)

ИД пациента: (выберите)

ФИО пациента: (выберите)

Дата рождения: (выберите)

Учетный номер: (выберите)

Описание исследования: (выберите)

Модальность: CT

Дата исследования: Любая

Поиск

Результаты: Выделите в поиске Модальность: CT Дата исслед: Любая Сост: Любая Жесткость: default

Сост.	ИД пациента	Пол	Число изображений	Дата/время исследования	Возраст	Открыть
09.2021		F	3330	23 Сент 2021 08:37	61y	
1889		F	891	27 Янв 2021 15:31	42y	
108		M	722	01 Февр 2021 16:37	69y	
0410936		F	562	23 Сент 2021 11:41	70y	
300918350170		M	1832	03 Март 2021 12:52	70y	
219/21		F	10047	11 Июнь 2021 16:40	34y	
623		M	2503	15 Апр 2022 11:08	58y	
160428699		F	716	01 Апр 2008 08:44	51y	

Последнее обновление: 7 мес. назад. Всего результатов: 83.

Приложение: Результаты Исход.

1.46 52 53 60 Lang module 2 | 1809474486 | -- | 24 Янв 2022 15:16 Инстр. Список Изображения

Сост.	Серия №	Число изображений	Дата/время исследования
1173522		751	
1175047		751	
1173629		1	
1173630		401	
1175155		1	
1175156		401	
1173544		482	
1173544		1	
1175110		482	
1175110		1	
6		401	24 Янв 2022 15:18:21
11		482	24 Янв 2022 15:18:34
14		751	24 Янв 2022 15:20:12
17		750	24 Янв 2022 15:20:51
500		1	14 Дек 2022 10:30:43
501		1	20 Дек 2022 11:00:31
502		1	23 Дек 2022 11:17:06
502		1	23 Дек 2022 11:17:39
503		1	23 Дек 2022 11:18:51

☐ обратитесь к инструкции по эксплуатации

Федеральный закон США разрешает продажу данного изделия только врачам или по распоряжению врача согласно Своду федеральных нормативных актов, раздел 21, часть 801.109(b)(1).

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ VITREA ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТОМ «ОБЩЕЕ УЧЕБНО-СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО VITREA».

Этот документ содержит важную информацию по технике безопасности при использовании ПО Vitrea и вопросам нормативно-правового регулирования. Доступность продуктов и отдельных функций зависит от вашего географического положения. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю или в службу поддержки клиентов.

Контактная информация

- По общим вопросам, не связанным с технической поддержкой, см. наш веб-сайт по адресу <https://www.us.medical.canon/HTT>
- Для получения технической поддержки свяжитесь с нами:
 - Если вы находитесь в США, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 1-800-208-3005.
 - Если вы находитесь за пределами США, обратитесь к дистрибьютору компании Canon Medical.
 - Адрес электронной почты: support@mi.medical.canon.
- Для получения печатной версии примечаний к выпуску, учебно-справочного руководства или руководства по установке обратитесь в службу поддержки по телефону 1-800-208-3005.

Информация о договоре

- Регион: другой
- Лицензиат: RP CANON MEDICAL SYSTEMS, LLC
- Идентификатор клиента: 79909
- Серийный номер: 00000000
- Идентификатор договора: 00000000

Информация о версии

Версия: 7.15.4.204

UDI (01)00850025268158(11)220808(10)7.15.4

 08.03.2022

ВСЕГО ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАННО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
84 ЛИСТА /ОВ/

