


Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК» по ШГИД.941629.001ТУ

Блок управления (передняя панель, модель «АСТІТОН»)



Блок управления (передняя панель, модель «АСТИТОН-А»)

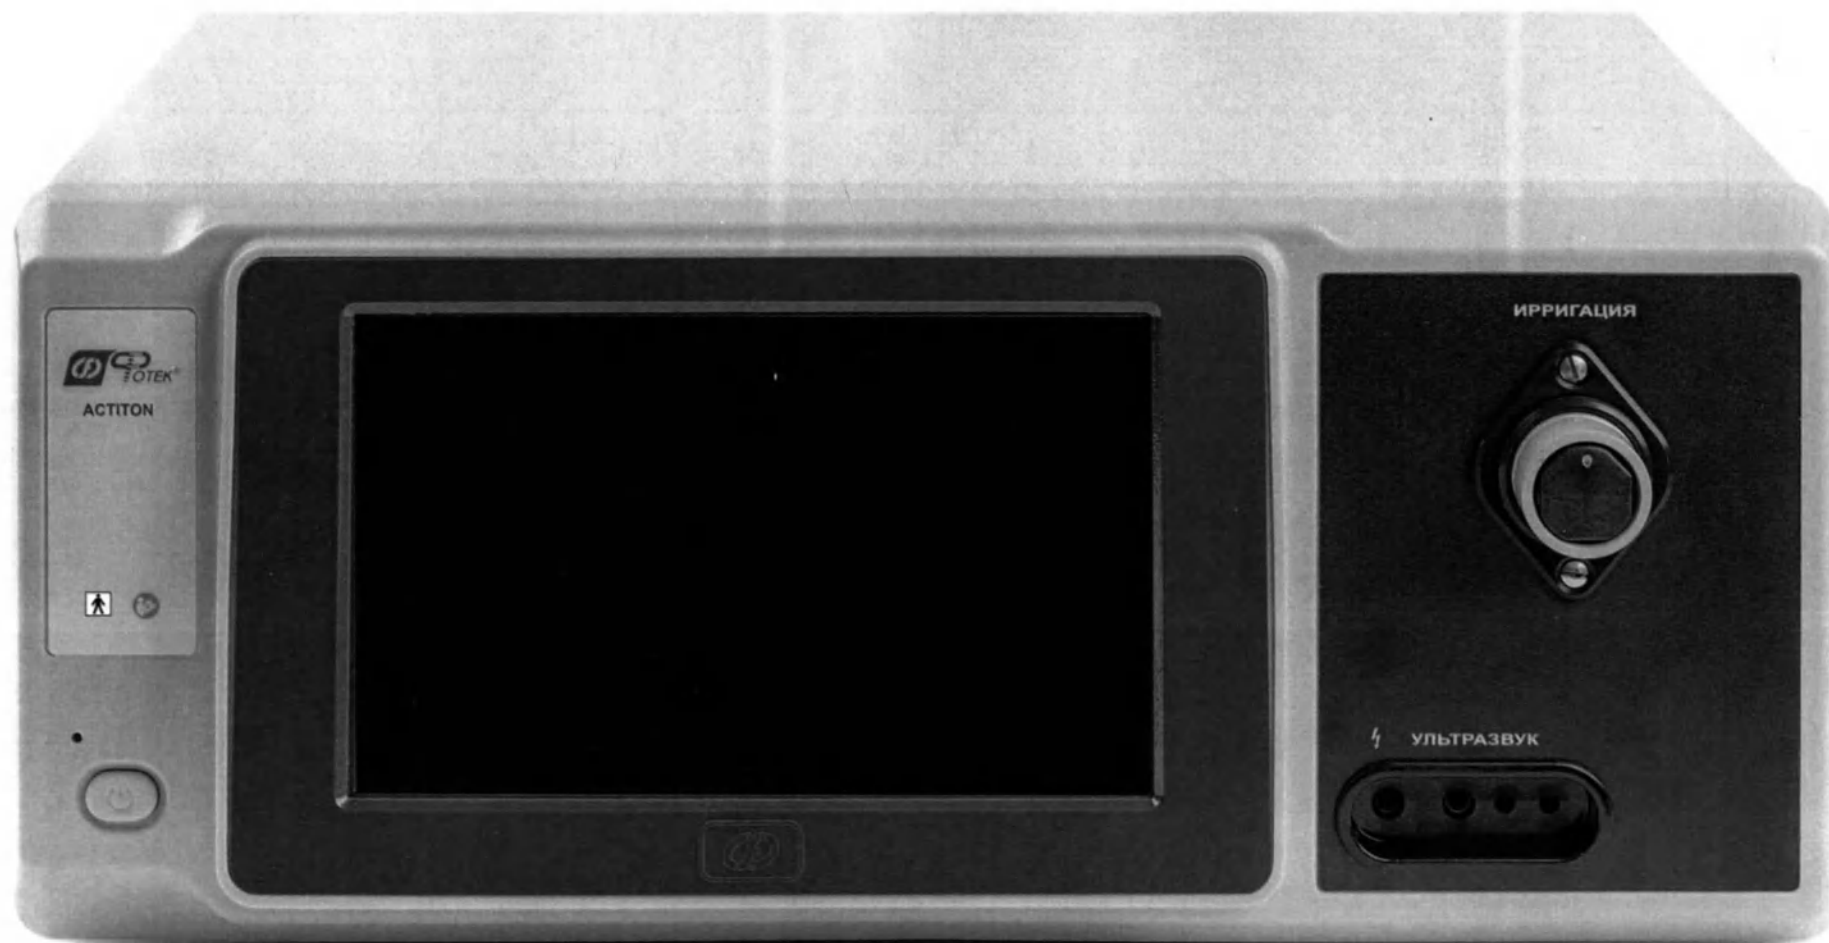


Блок управления (передняя панель, модель «АСТИТОН-В»)




Блок управления (передняя панель, модель «АСТИТОН-АВ»)




Блок управления (задняя стенка, модель «АСТІТОН»)

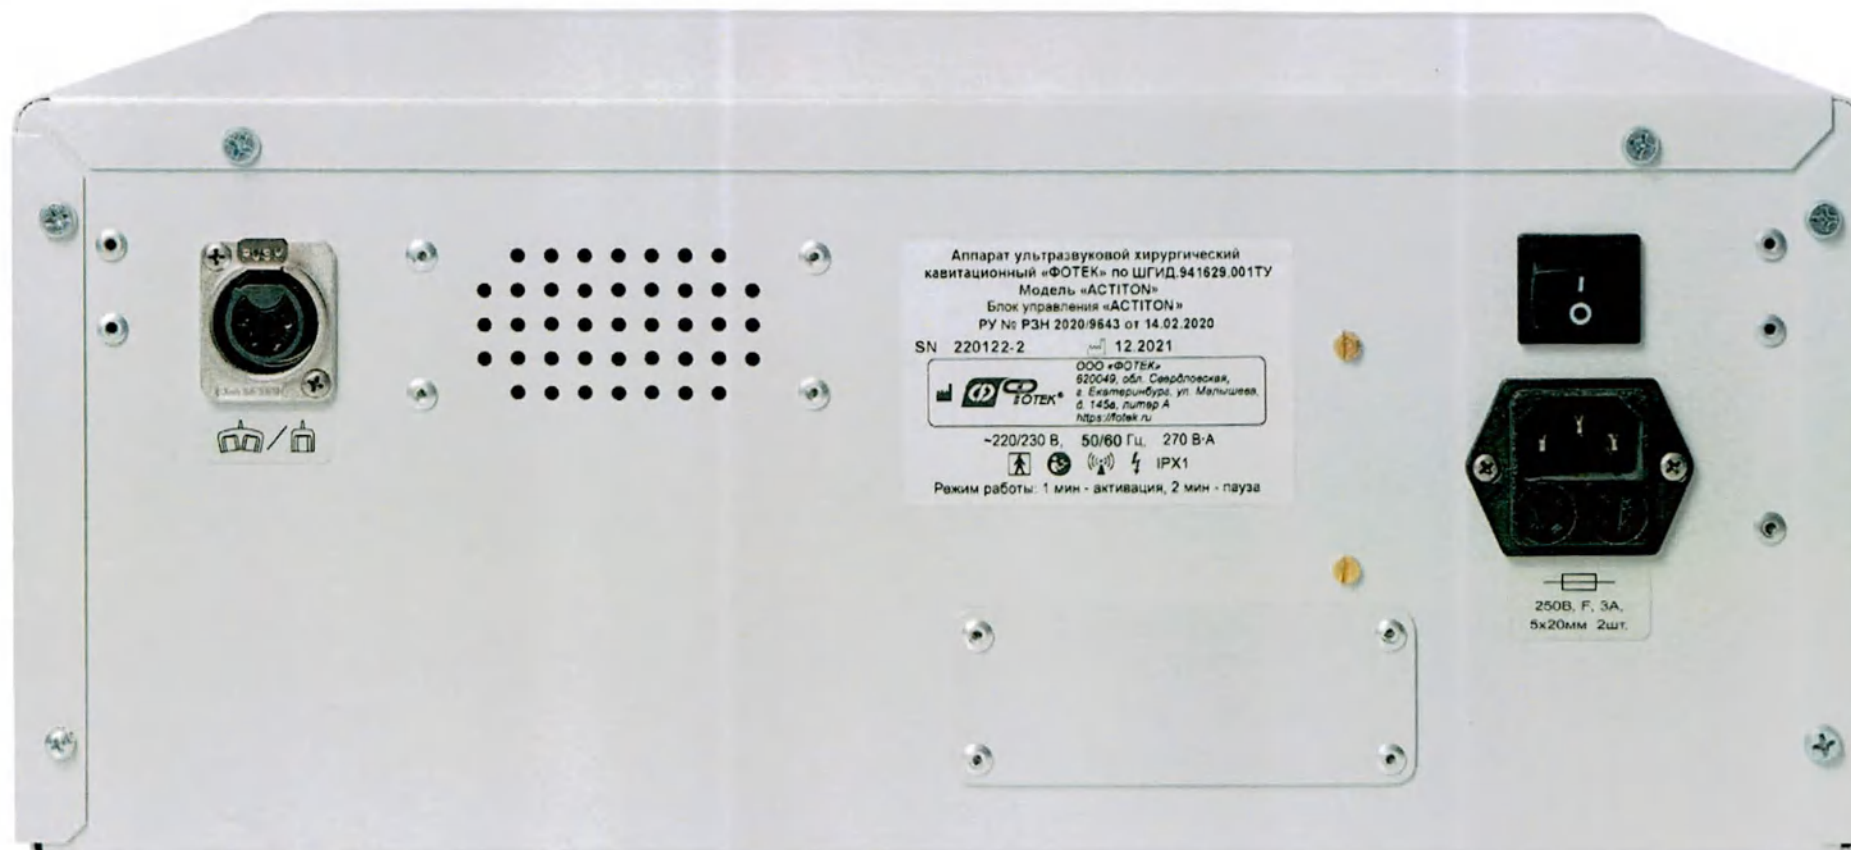


Блок управления (задняя стенка, модель «АСТИТОН-А»)

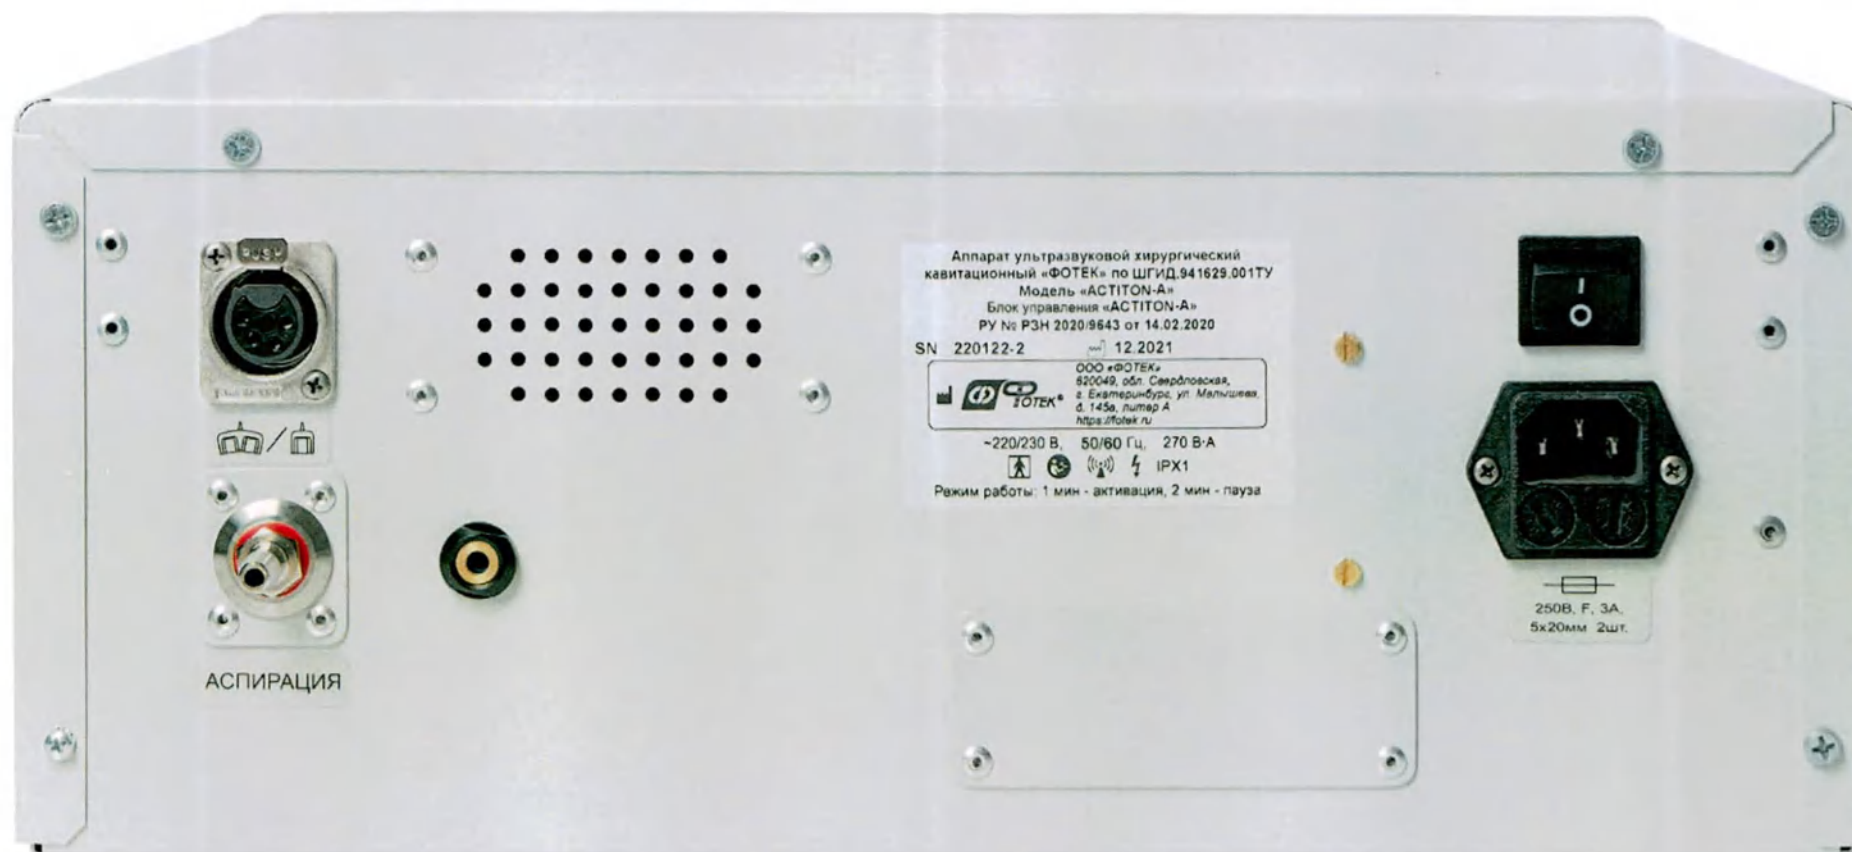

Блок управления (задняя стенка, модель «АСТИТОН-В»)

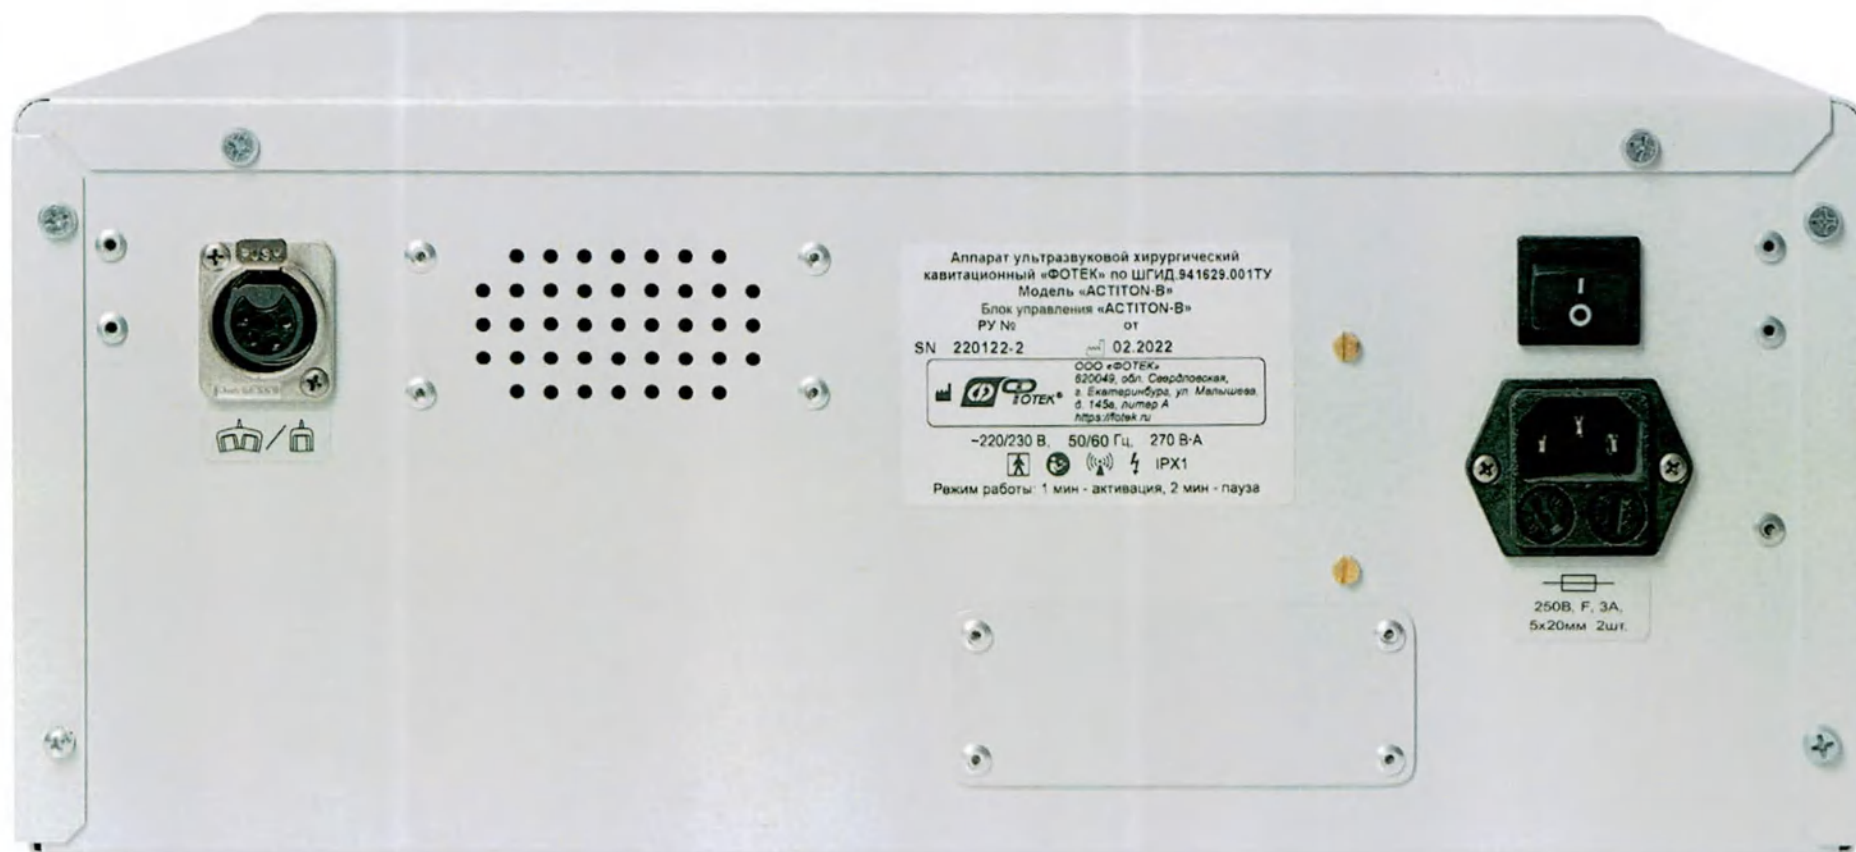

Блок управления (задняя стенка, модель «АСТИТОН-АВ»)

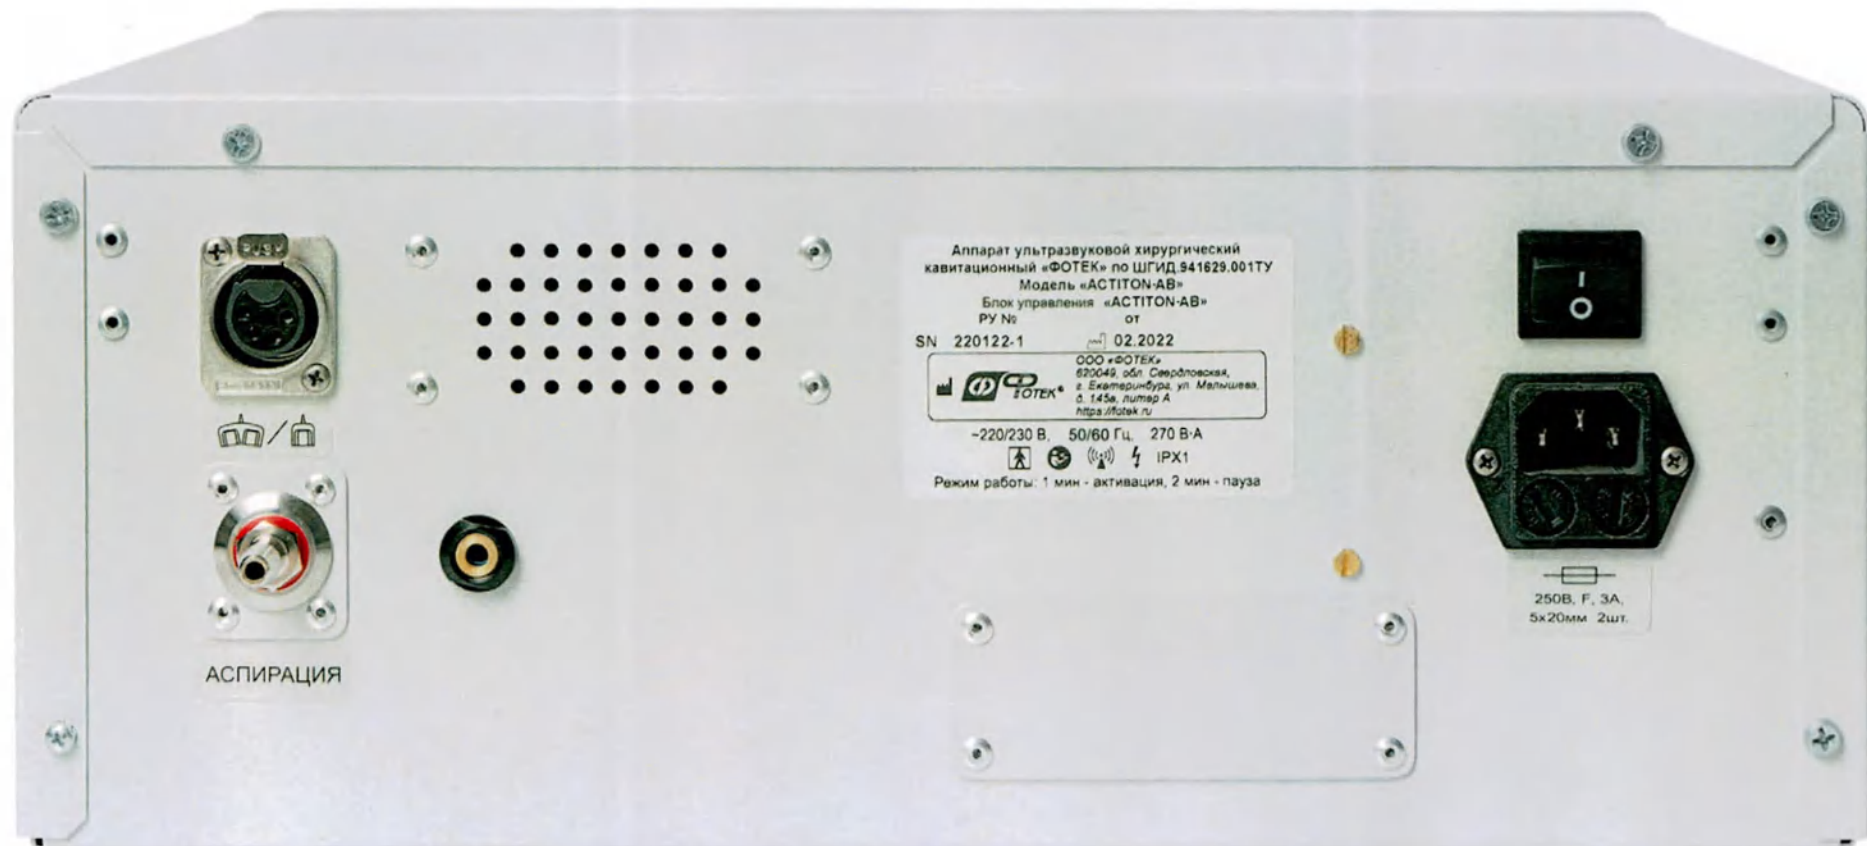

Головка перистальтического насоса, расположенного на передней панели блока управления, (только для аппаратов моделей «АСТИТОН-АВ» и «АСТИТОН-В»)




Педадь двухклавишная



Педадь двухклавишная беспроводная



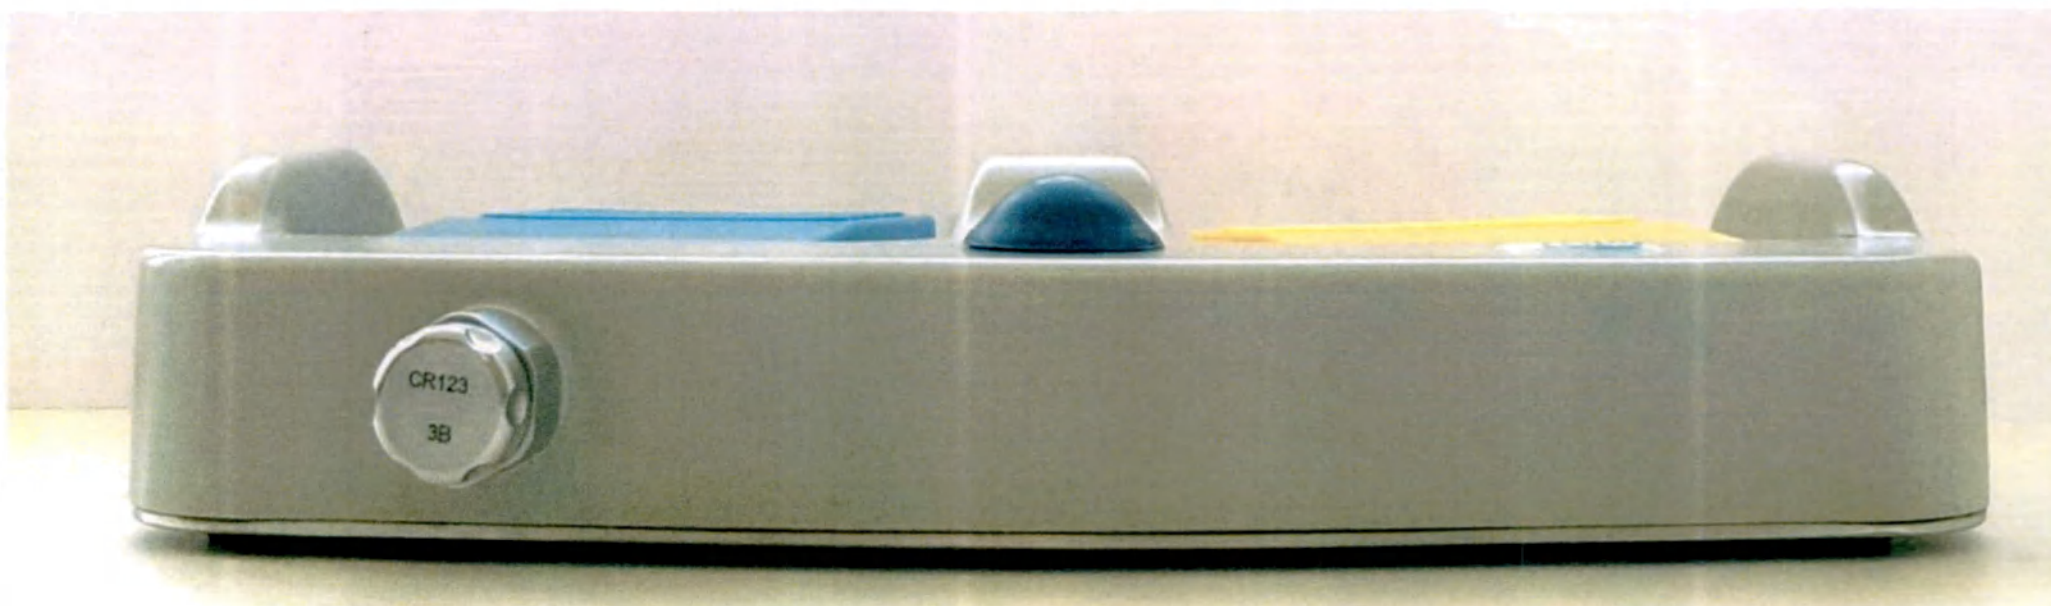

Педадь одноклавишная



Педадь одноклавишная беспроводная







Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента. Исполнение 1



Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента. Исполнение 2

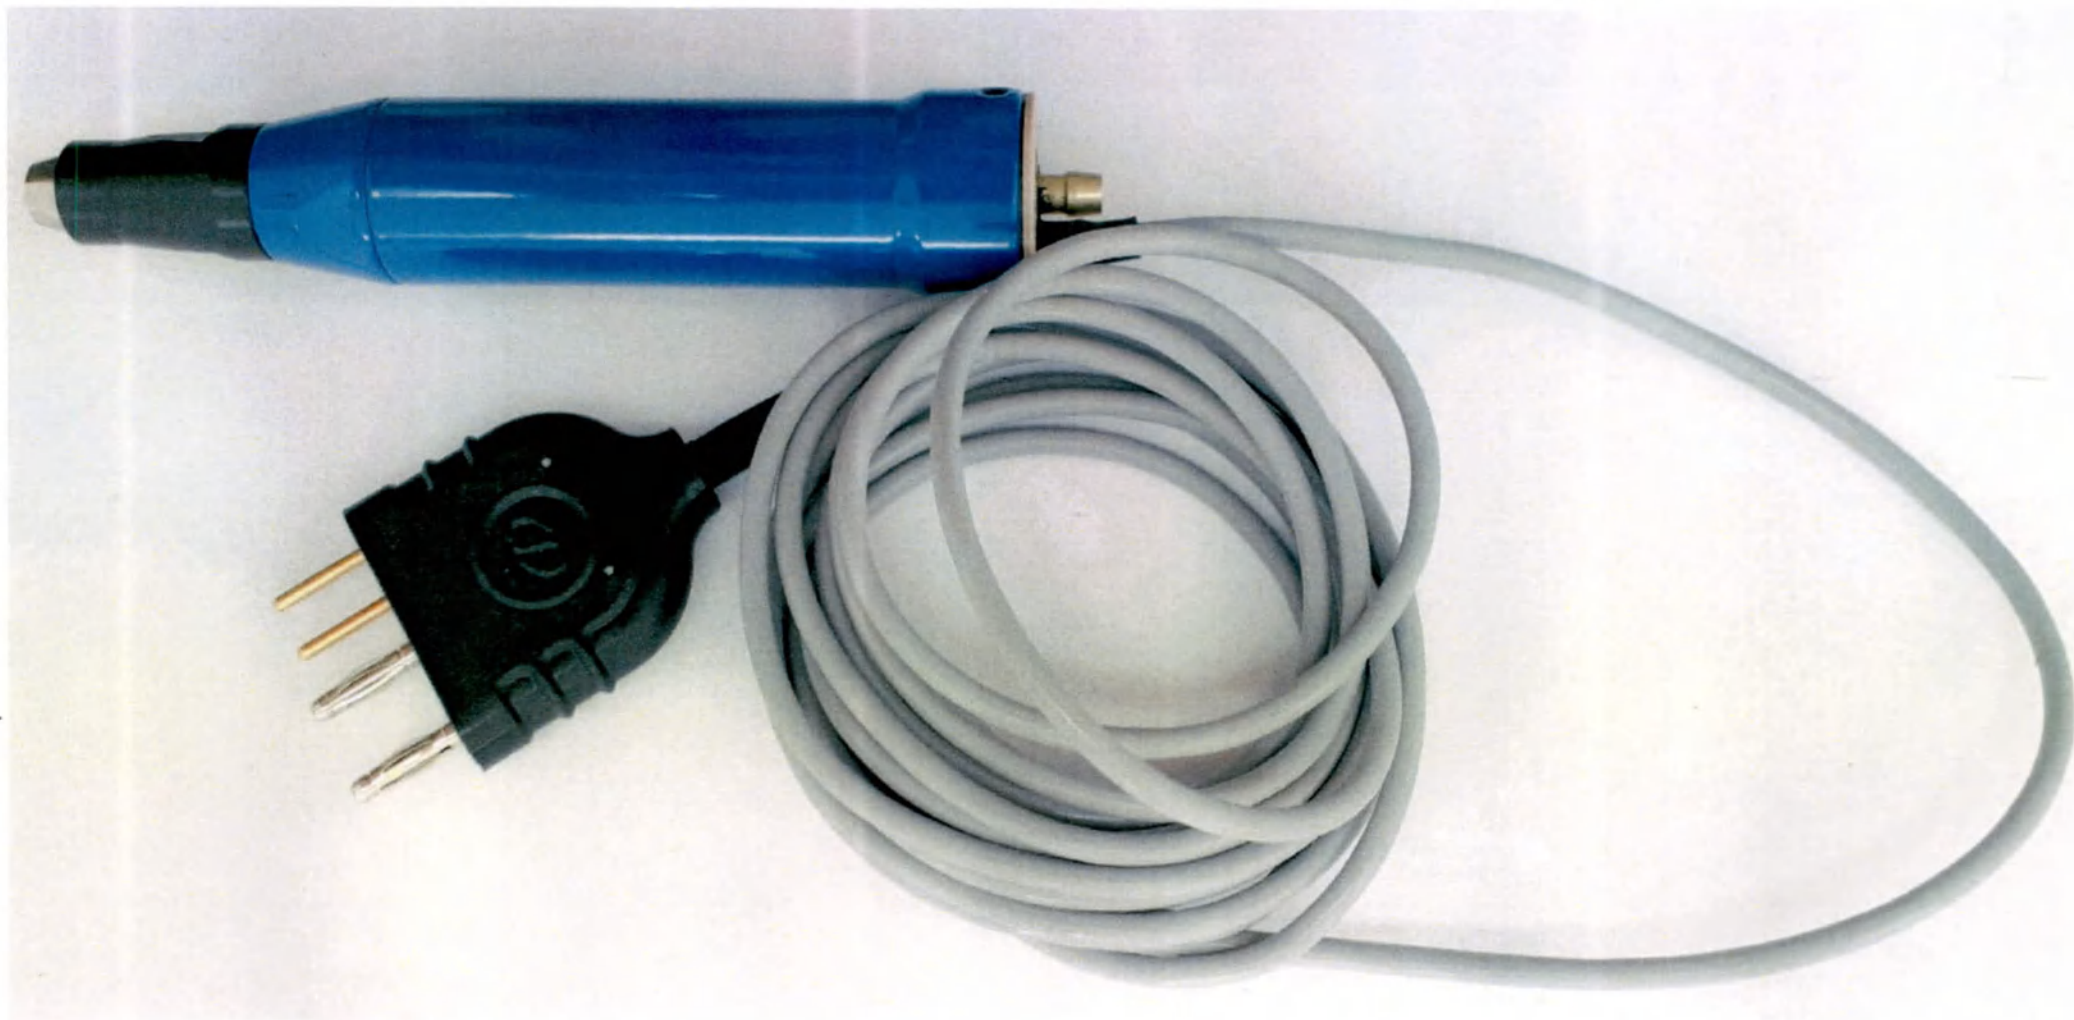


Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента. Исполнение 3

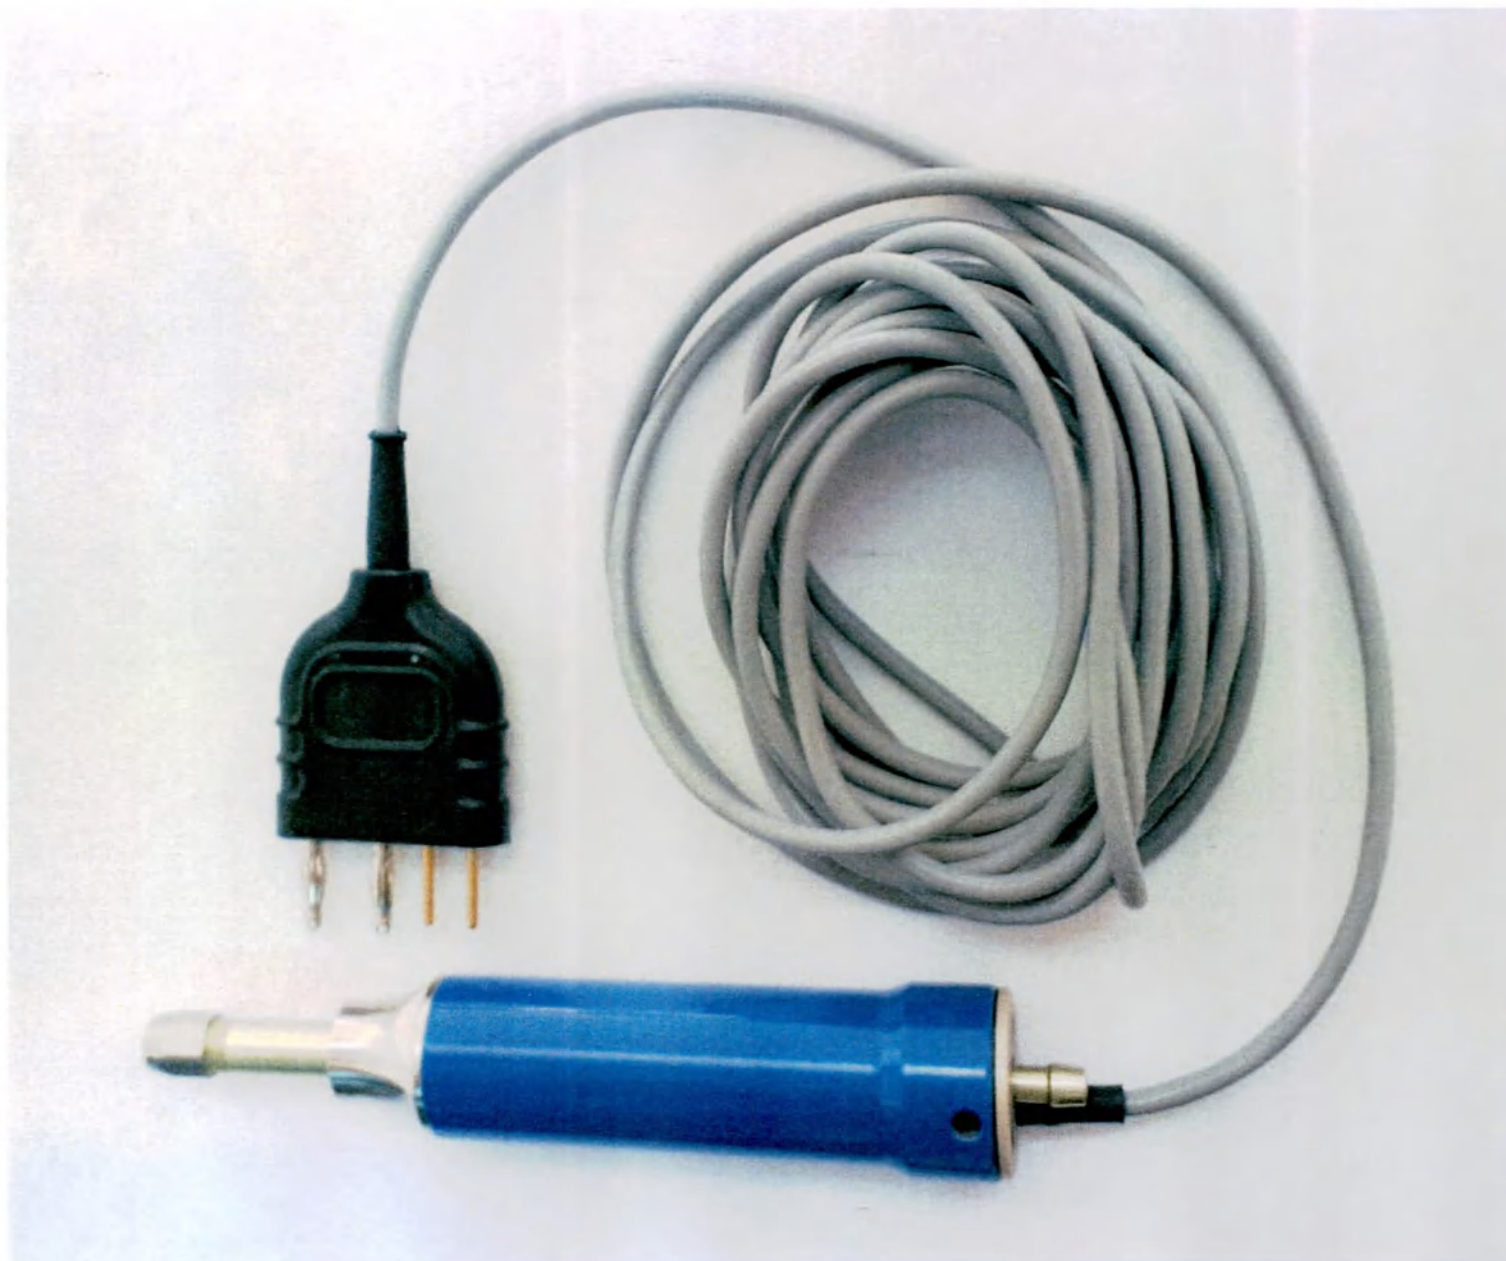


Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента. Исполнение 4




Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента. Исполнение 5

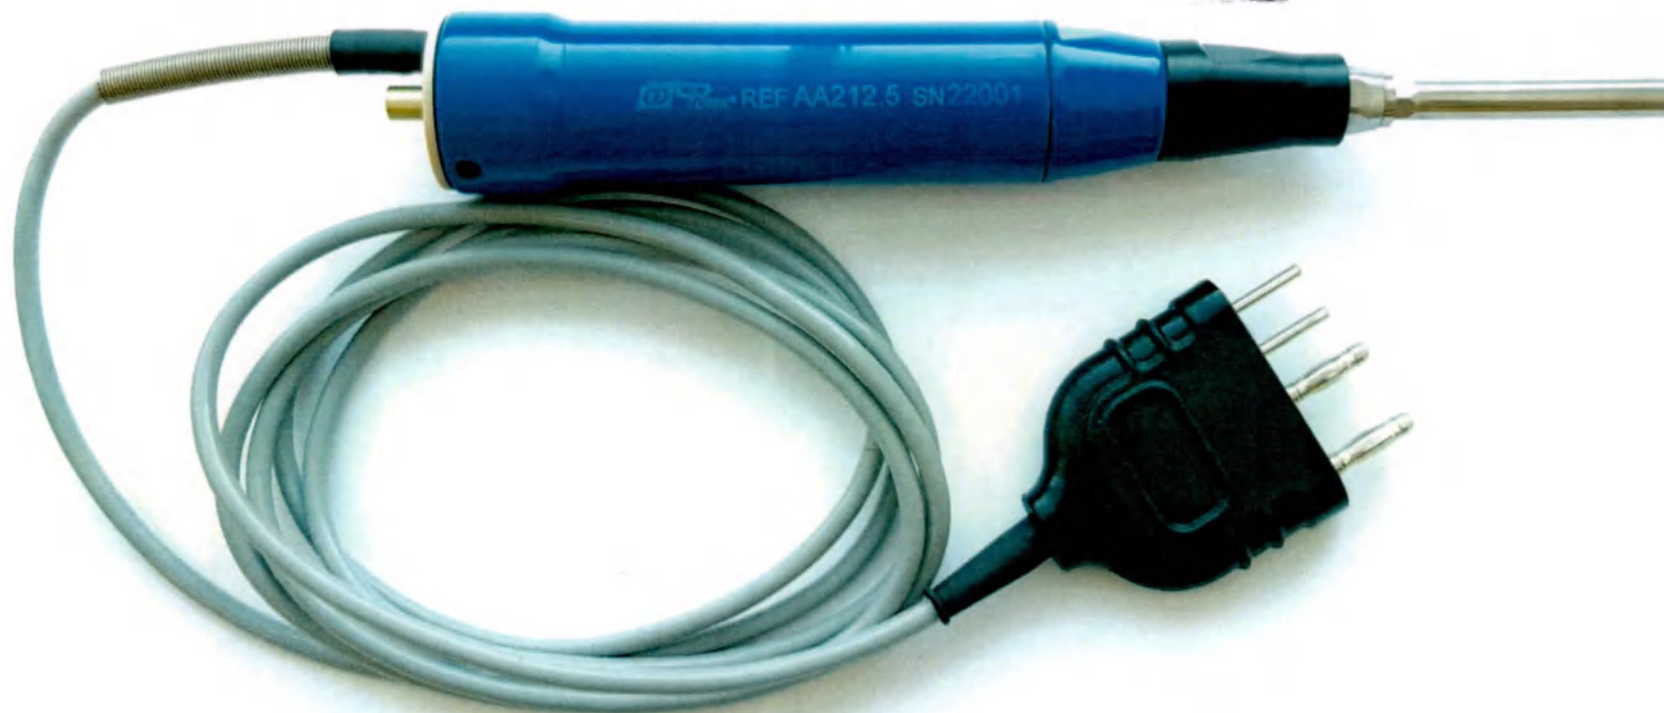


Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом. Исполнение 1

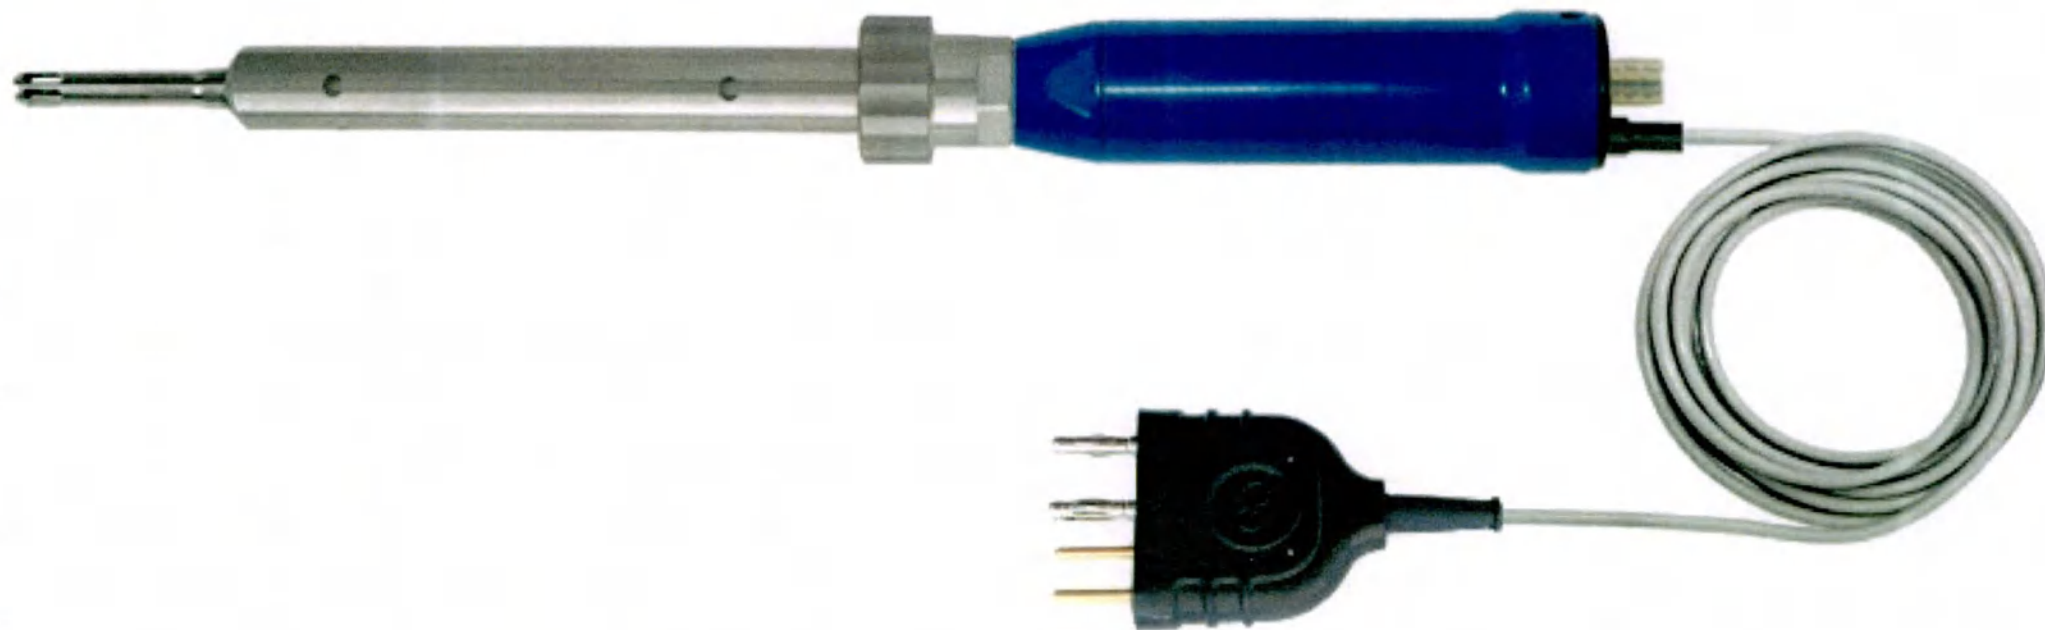

Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом. Исполнение 2

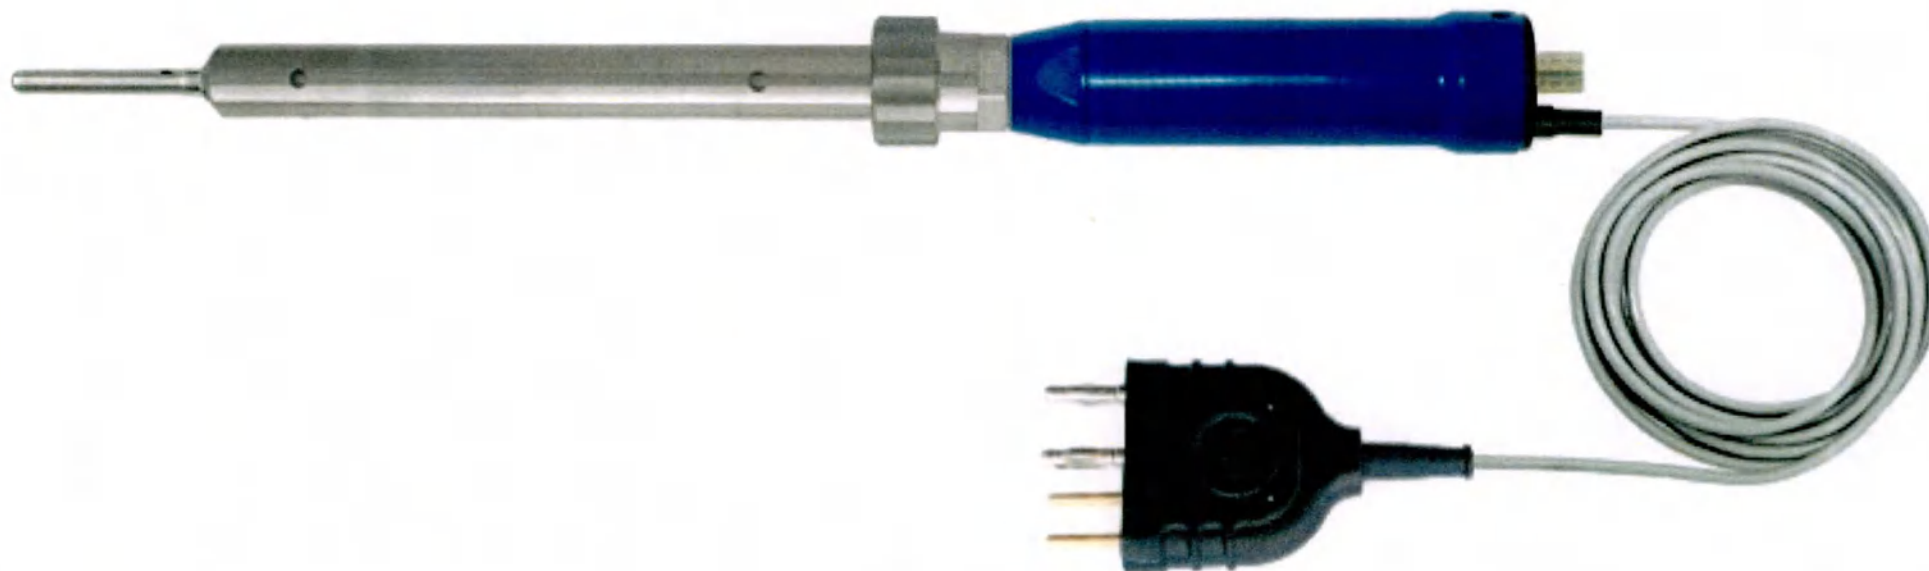

Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом. Исполнение 3

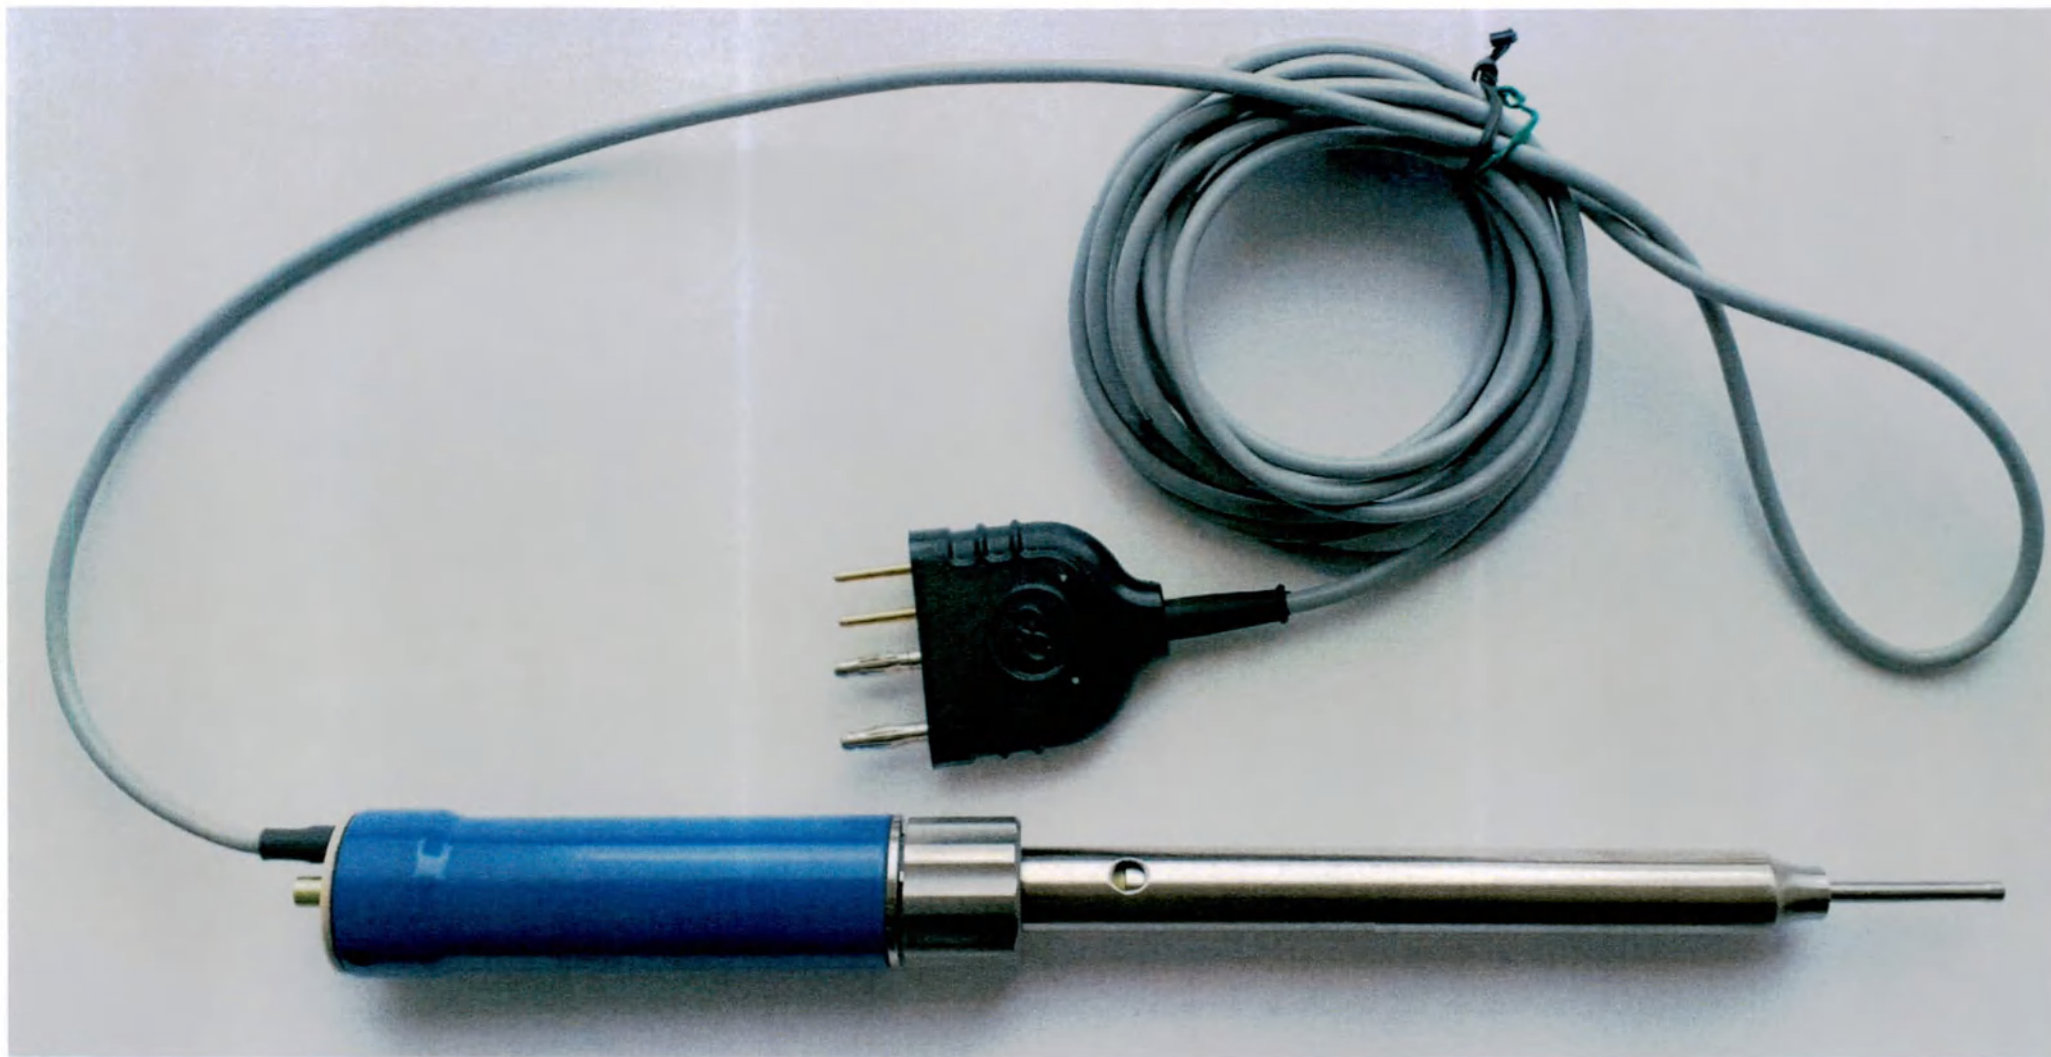


Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом. Исполнение 4



Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом. Исполнение 1




Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом. Исполнение 2

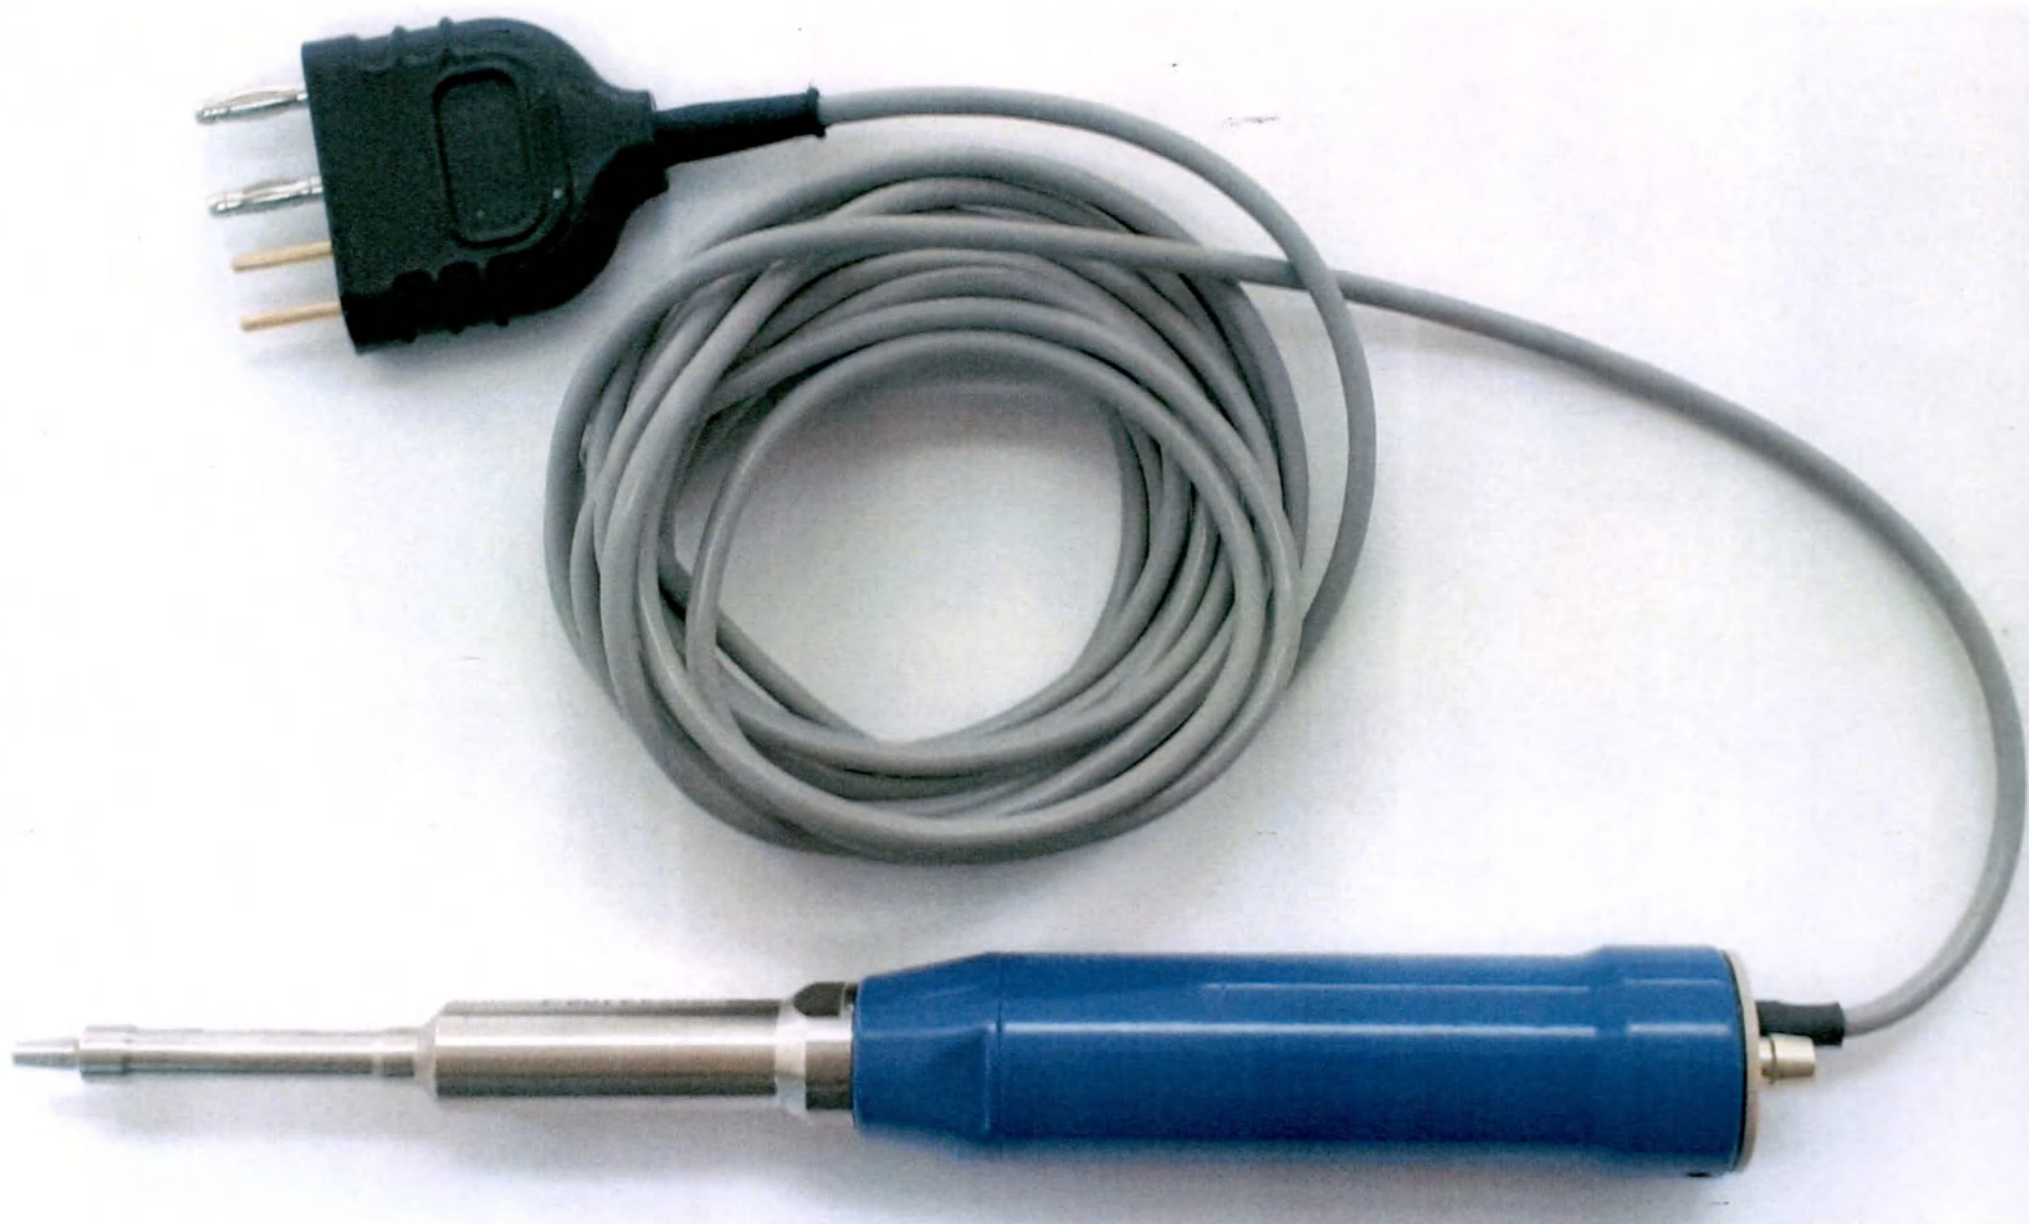


Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом. Исполнение 3




Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом. Исполнение 4

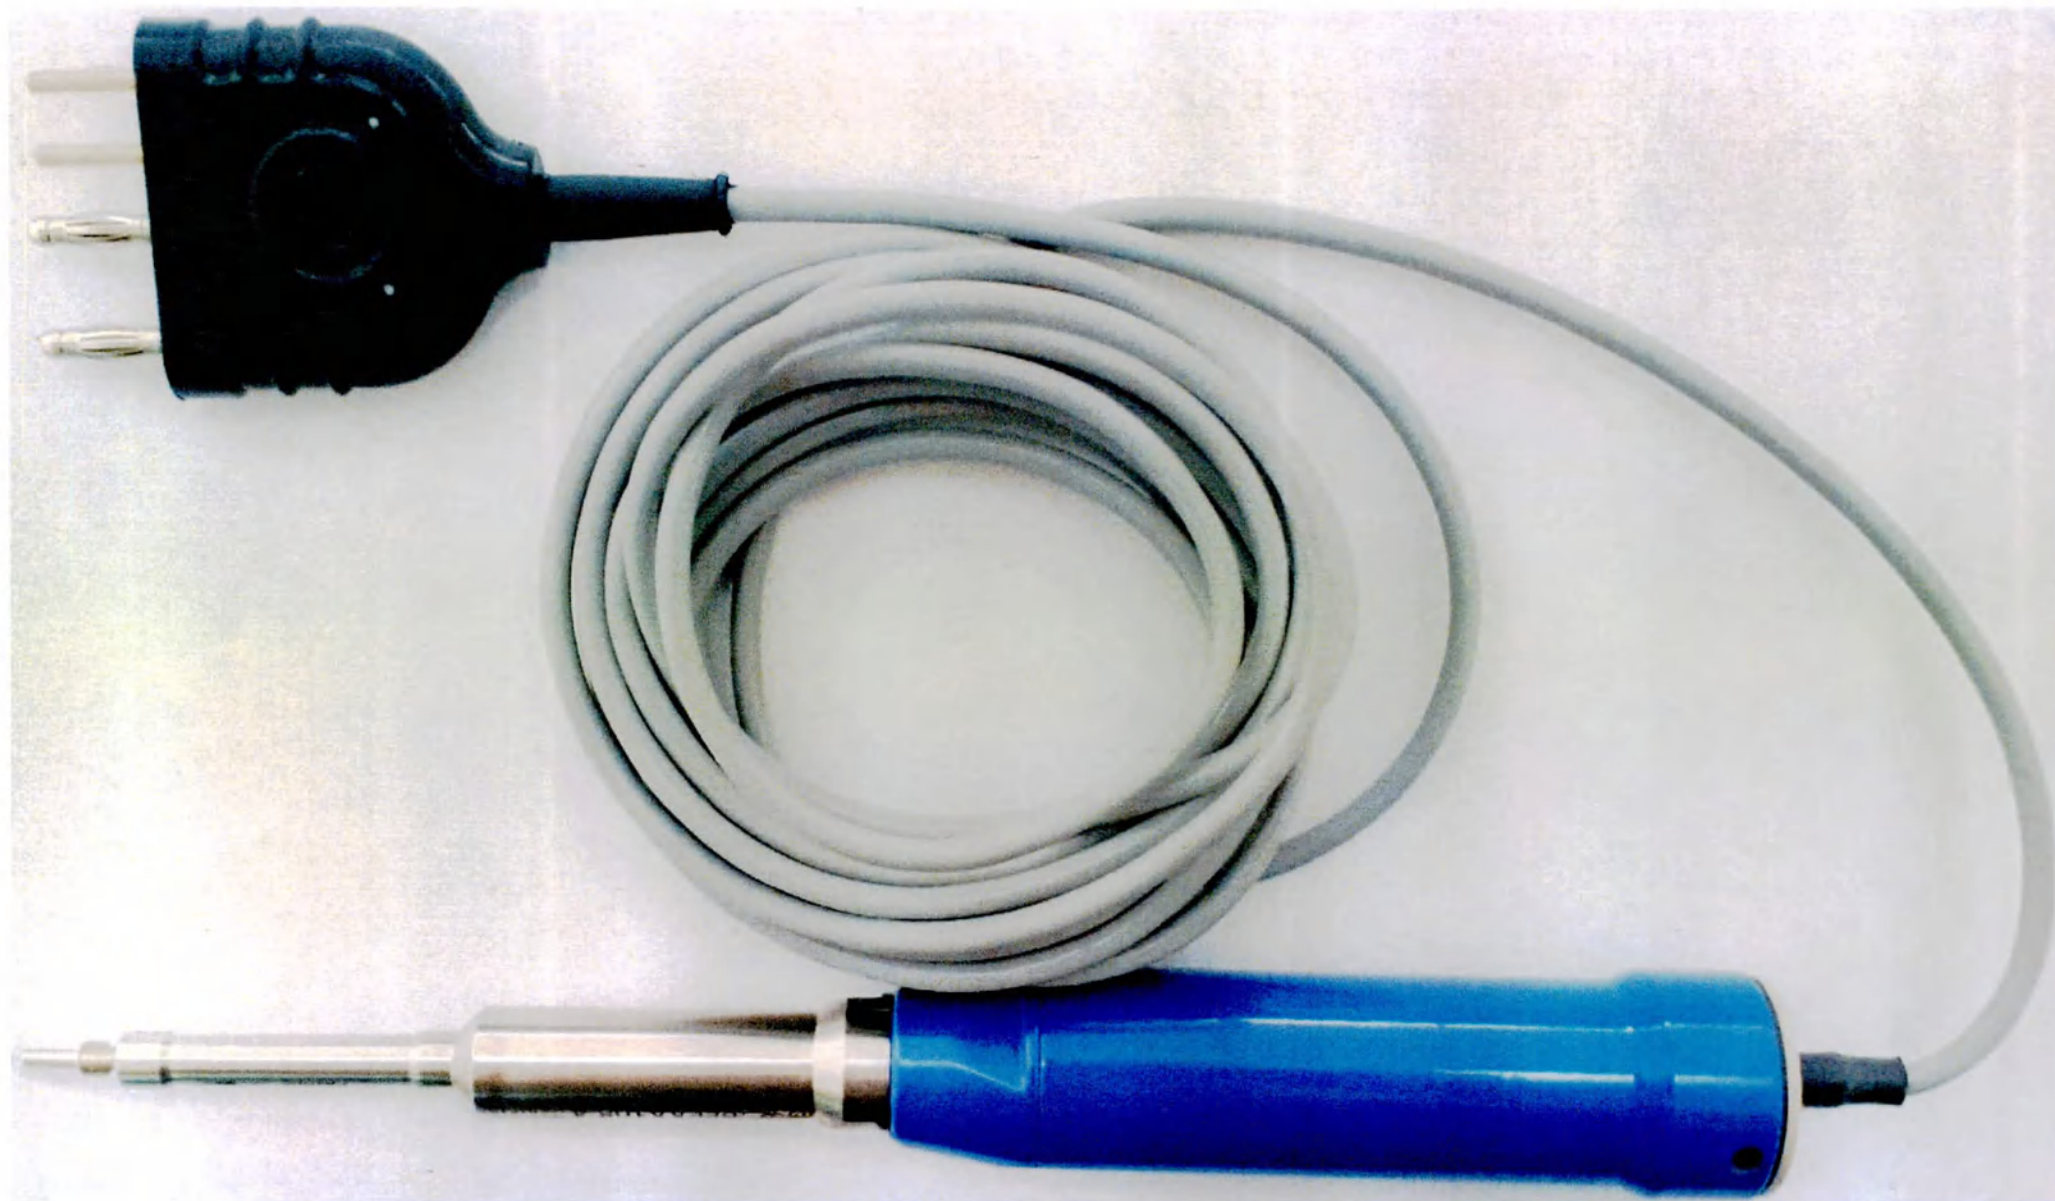

Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом. Исполнение 5

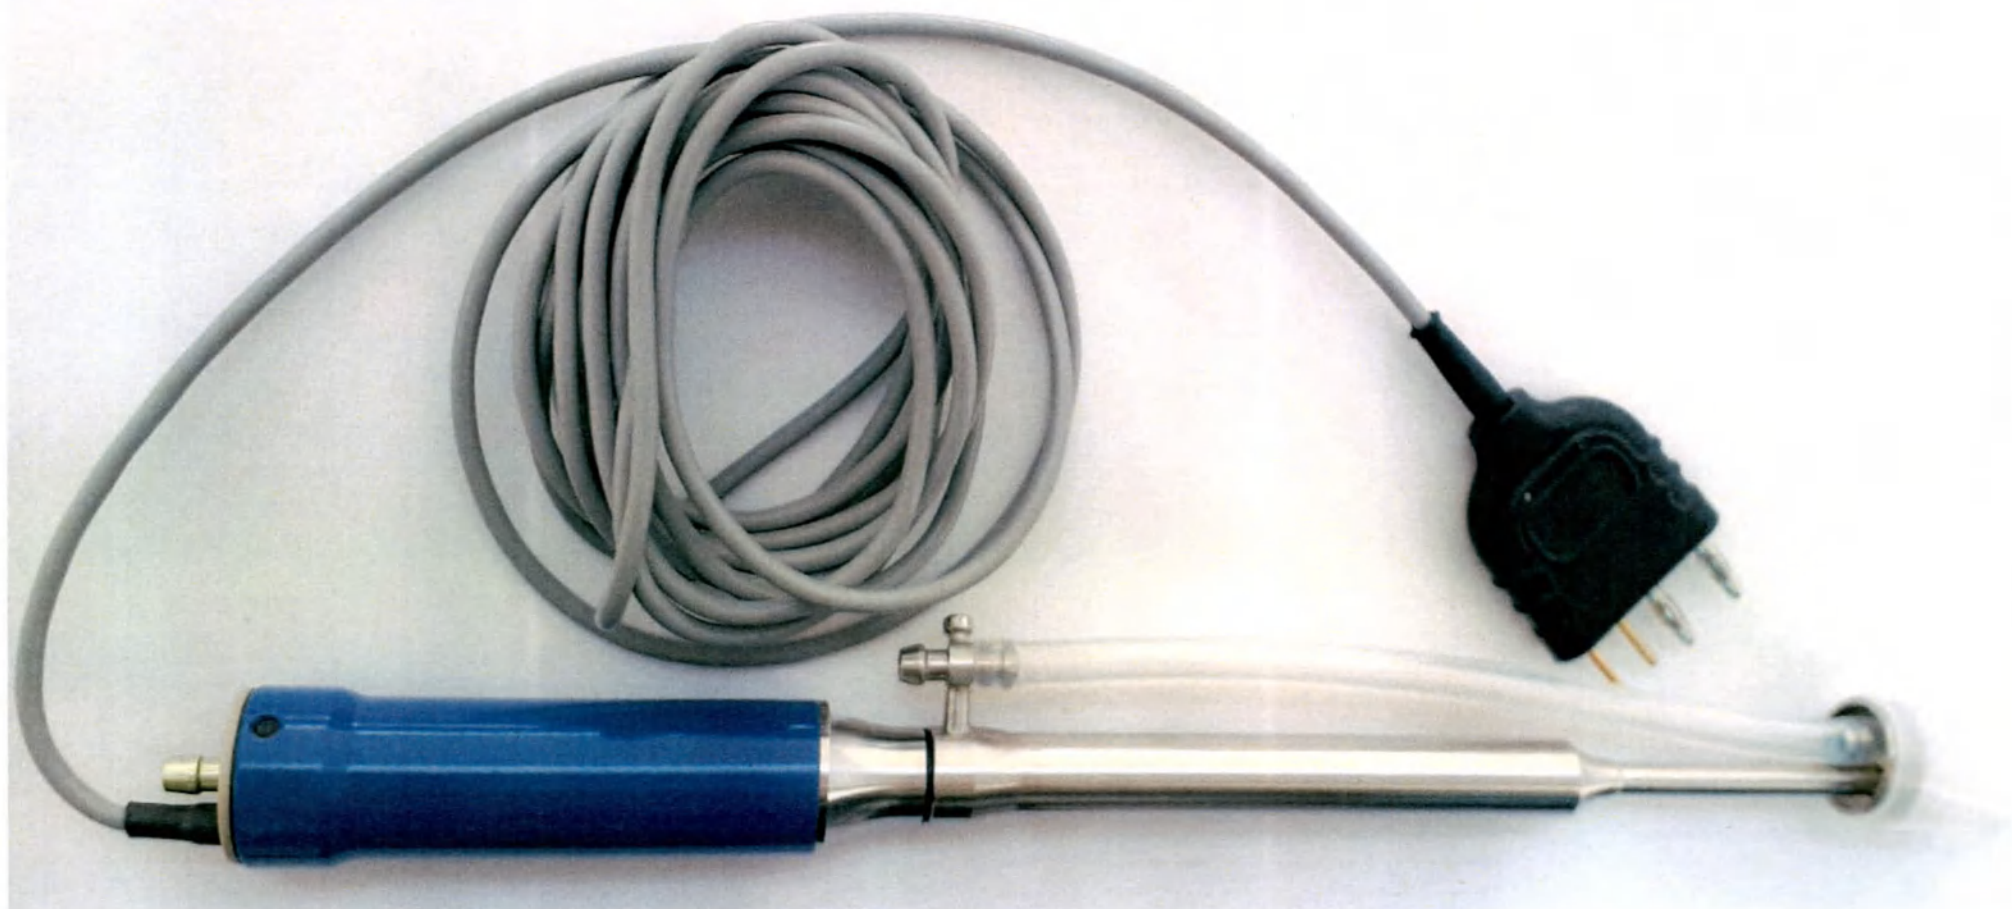

Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 1

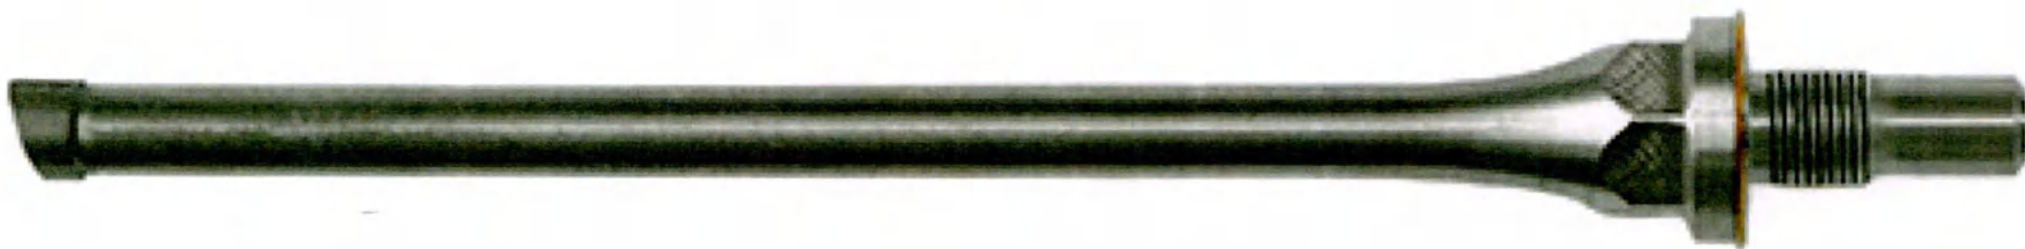


Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 2



Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 3




Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 4

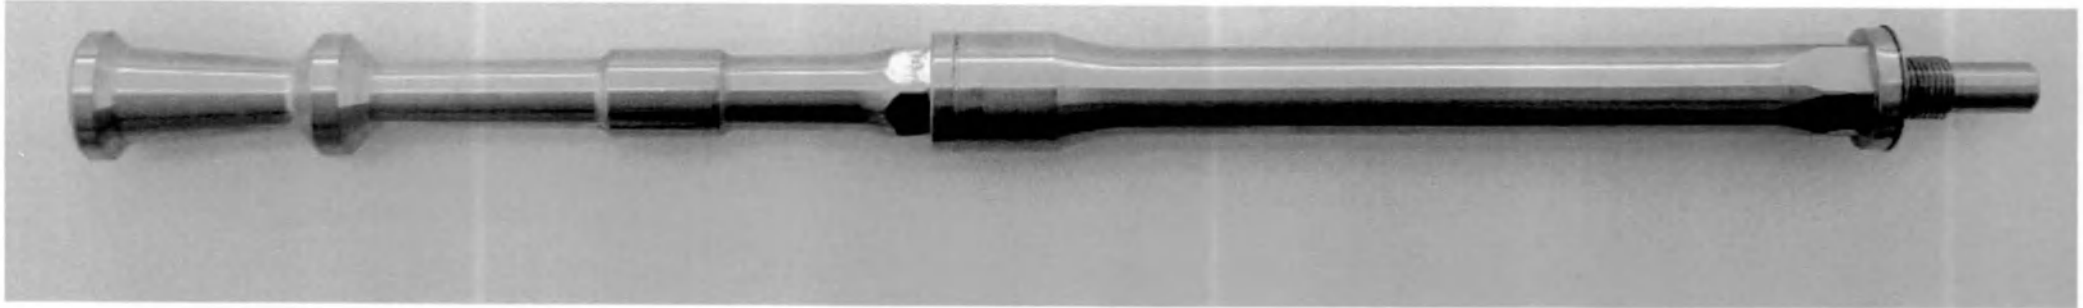


Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 5




Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 6

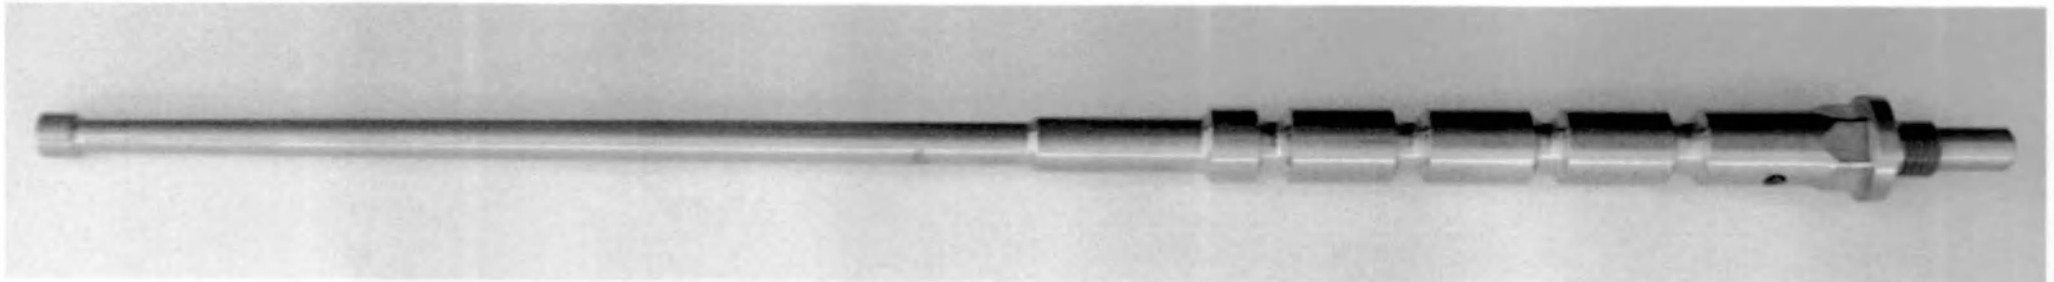

Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 7

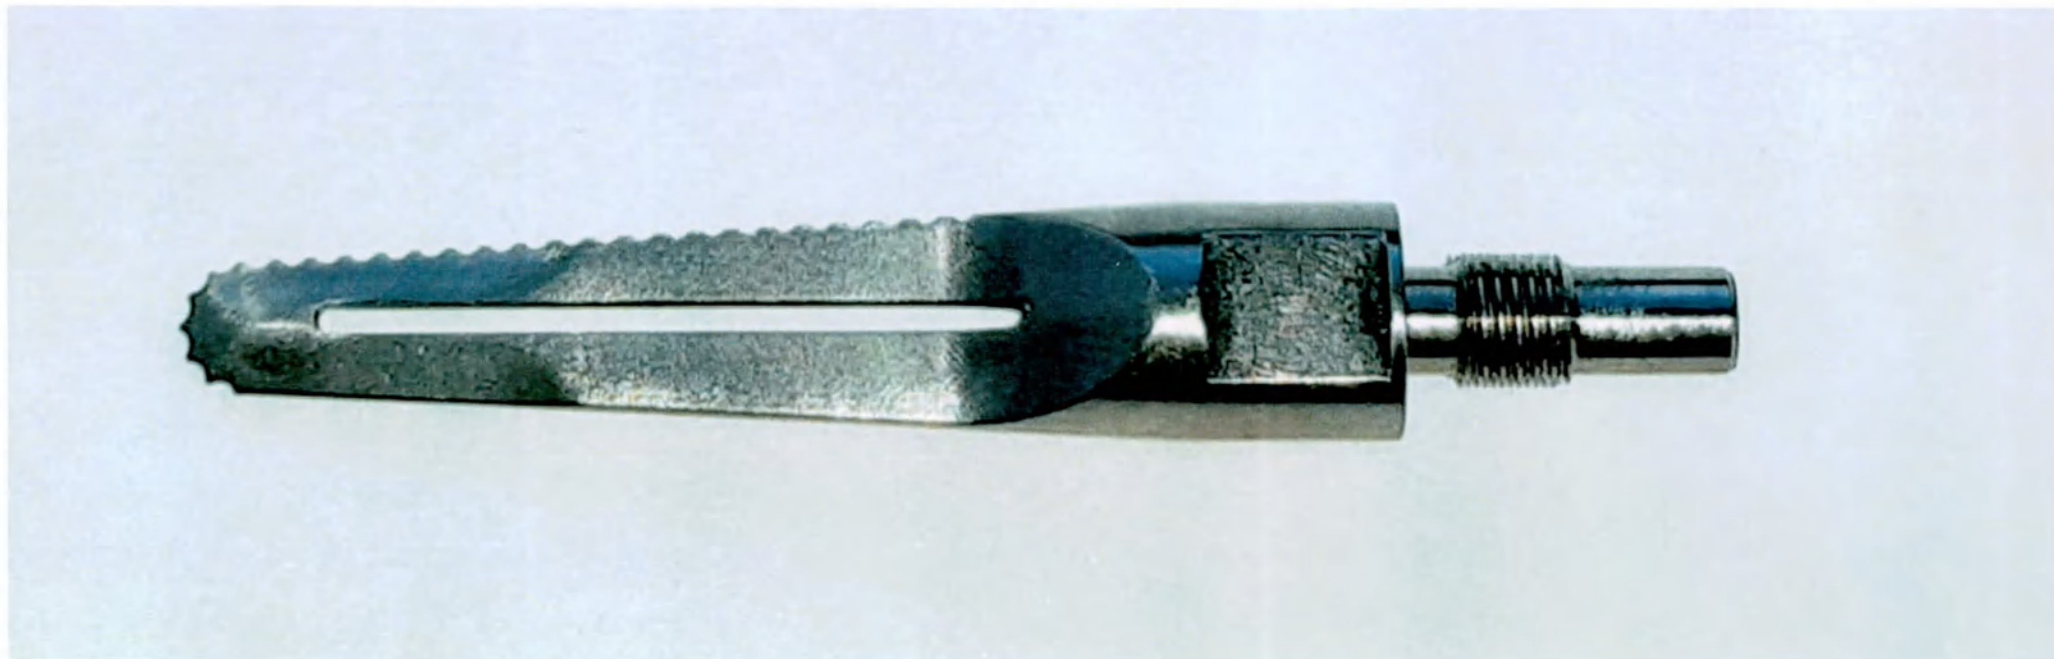

Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 8

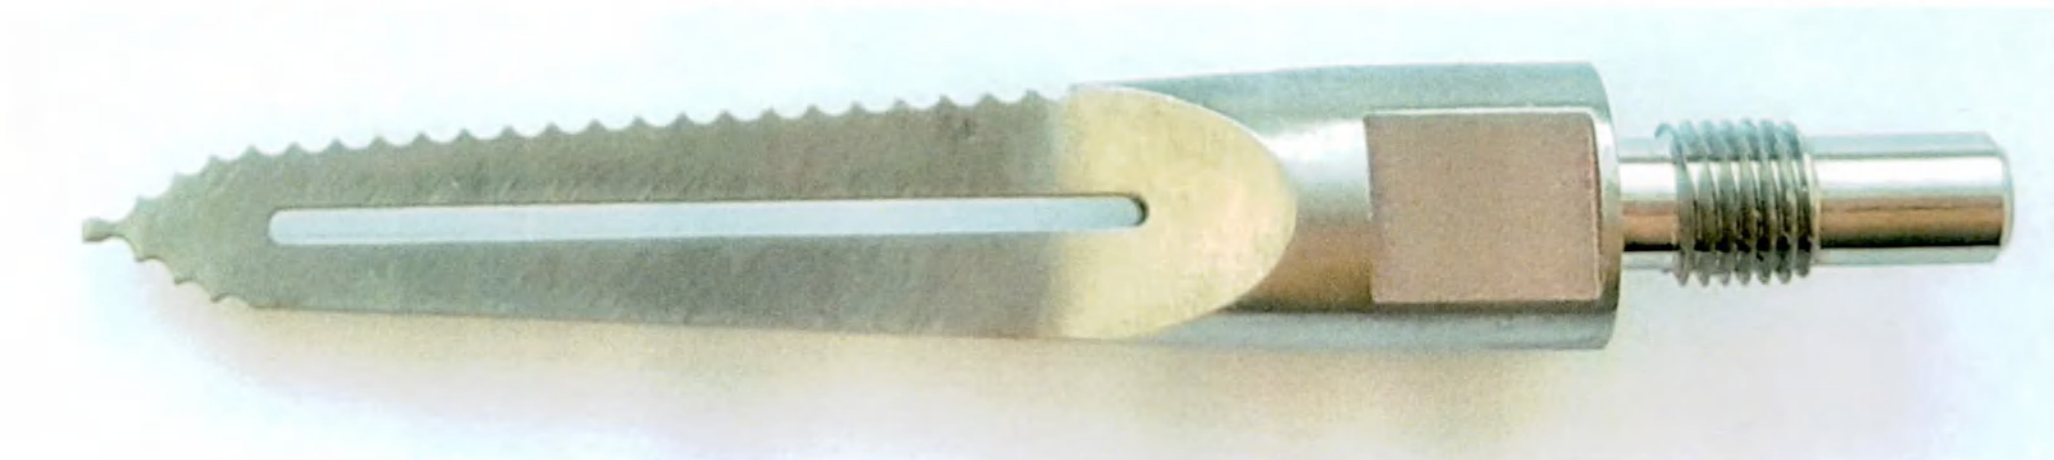


Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 9



Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 10




Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 11

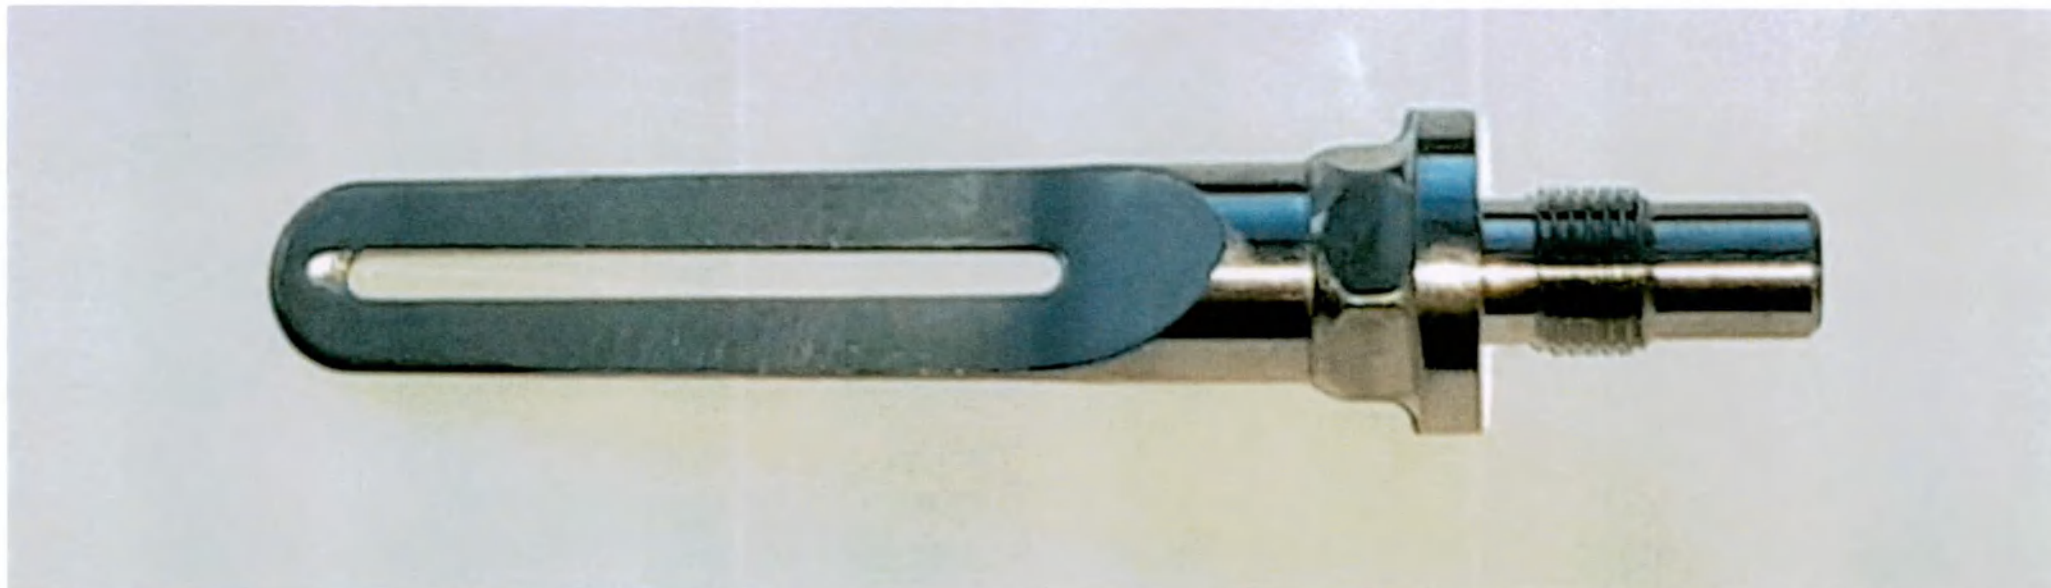


Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 12



Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 13

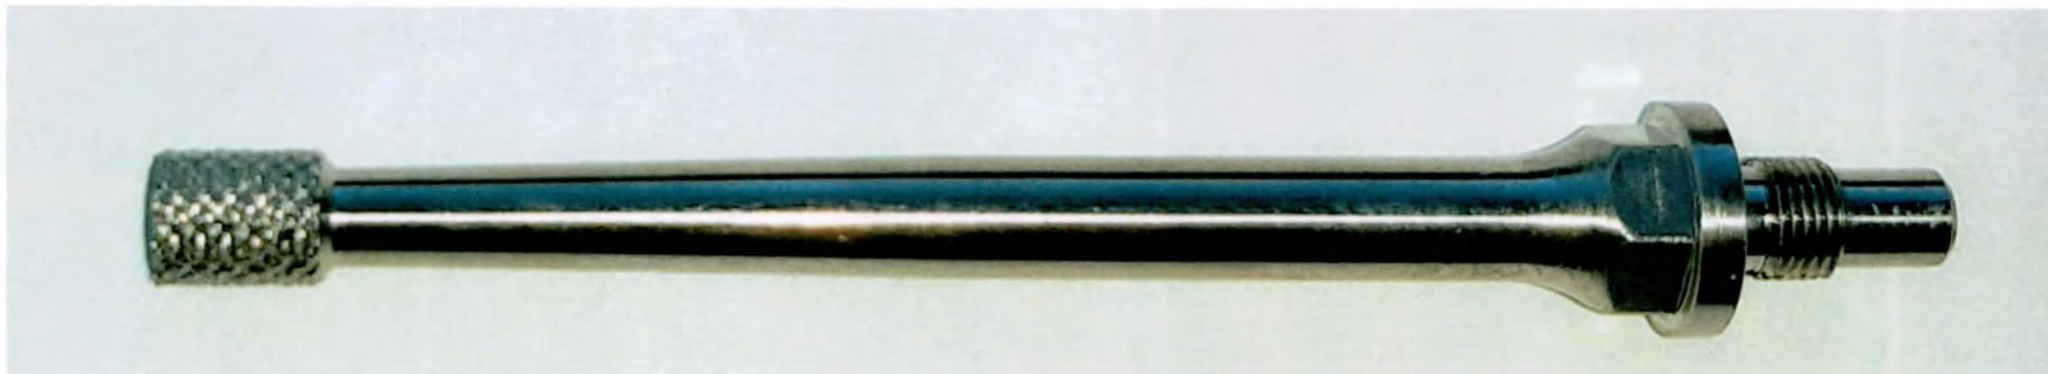


Инструмент ультразвуковой сменный. Исполнение 14

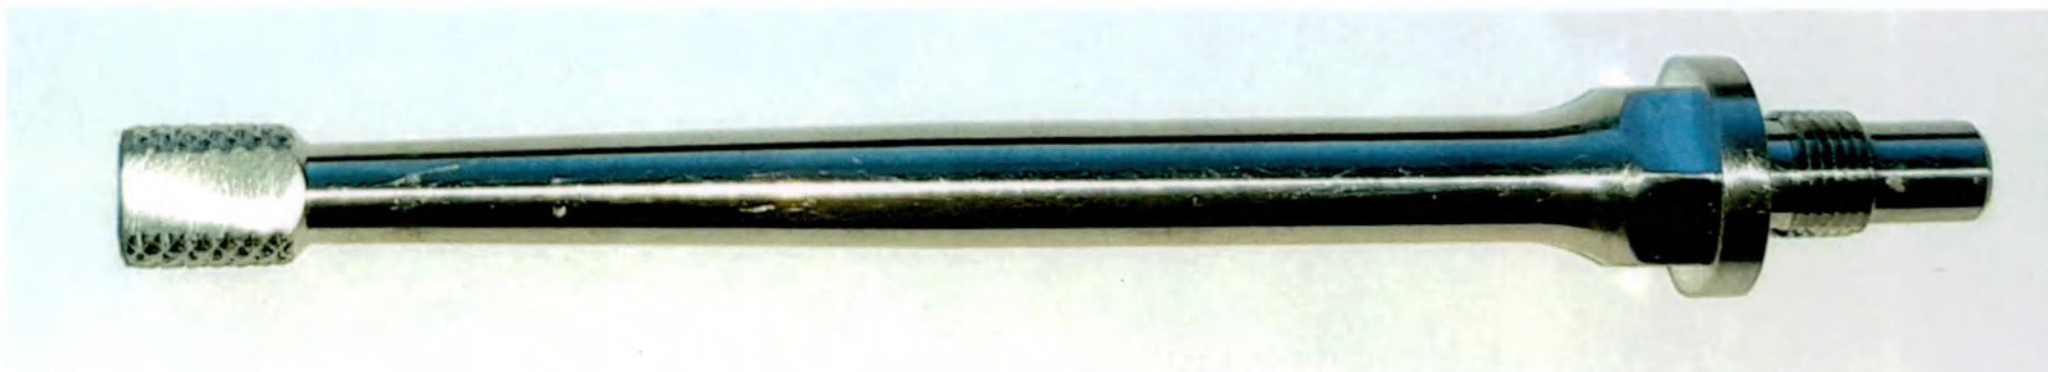


Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 1




Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 2

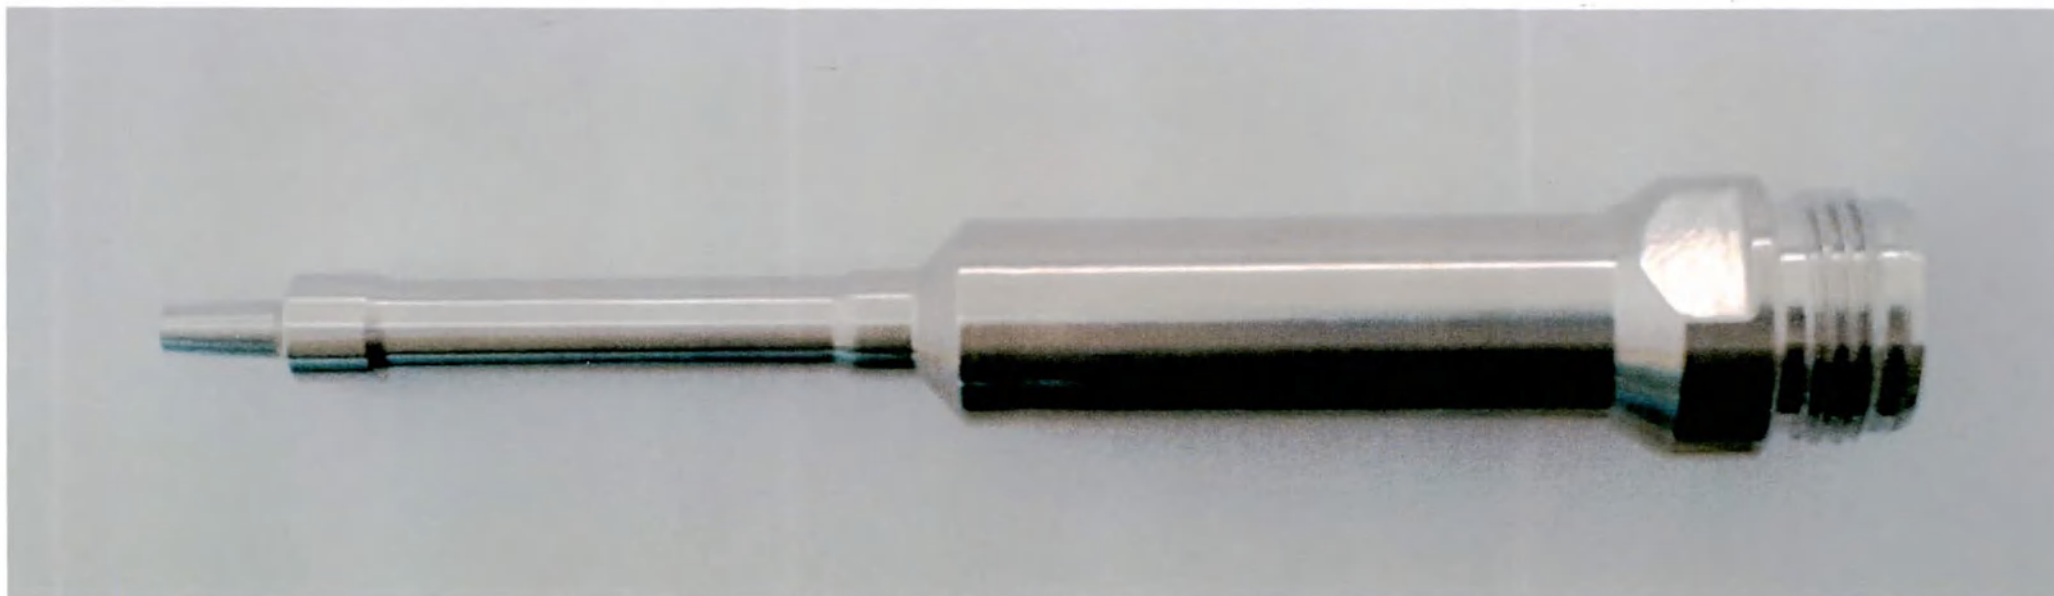


Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 3

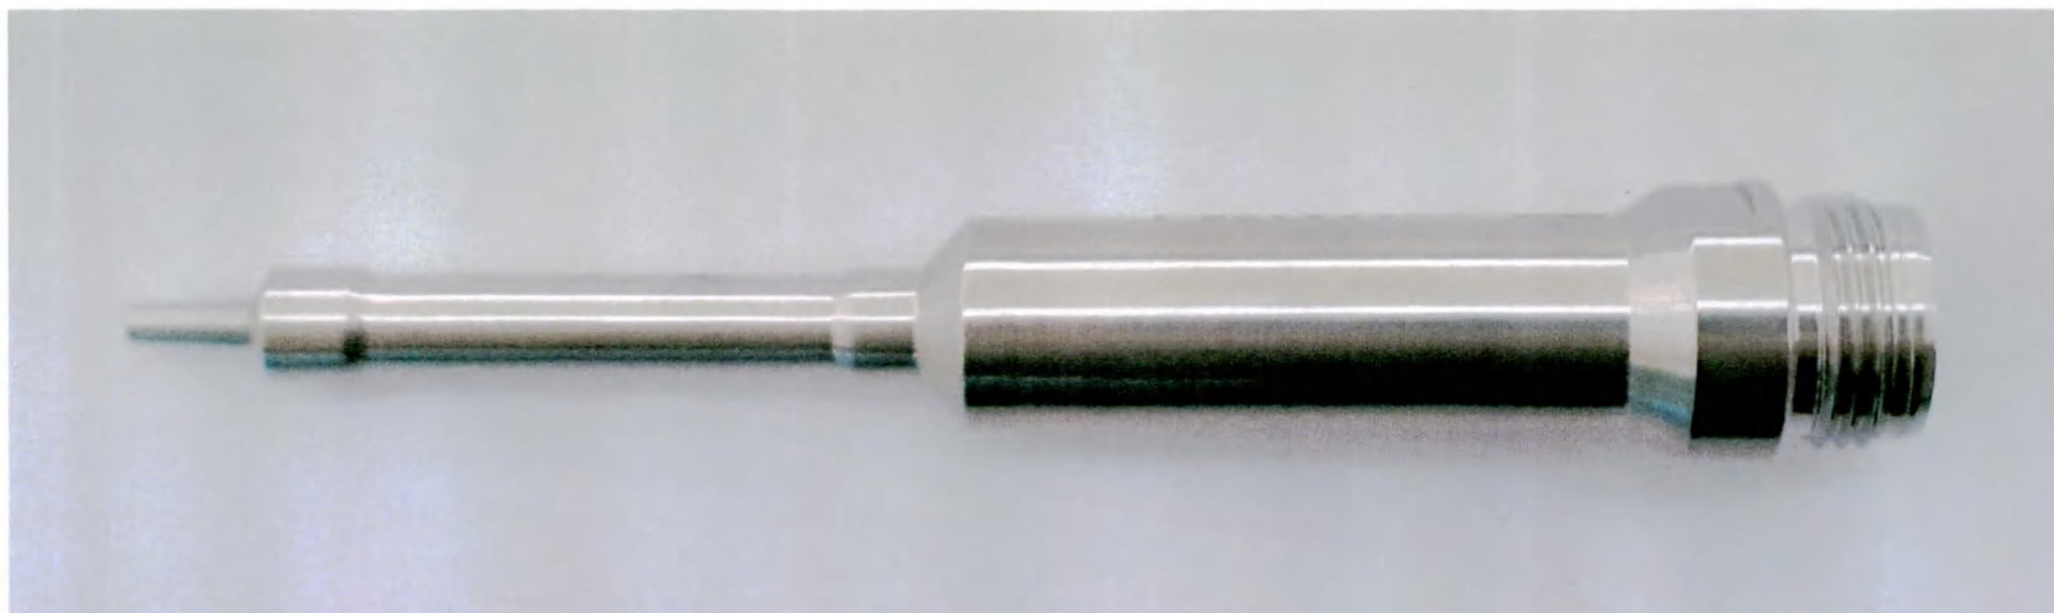


Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 4

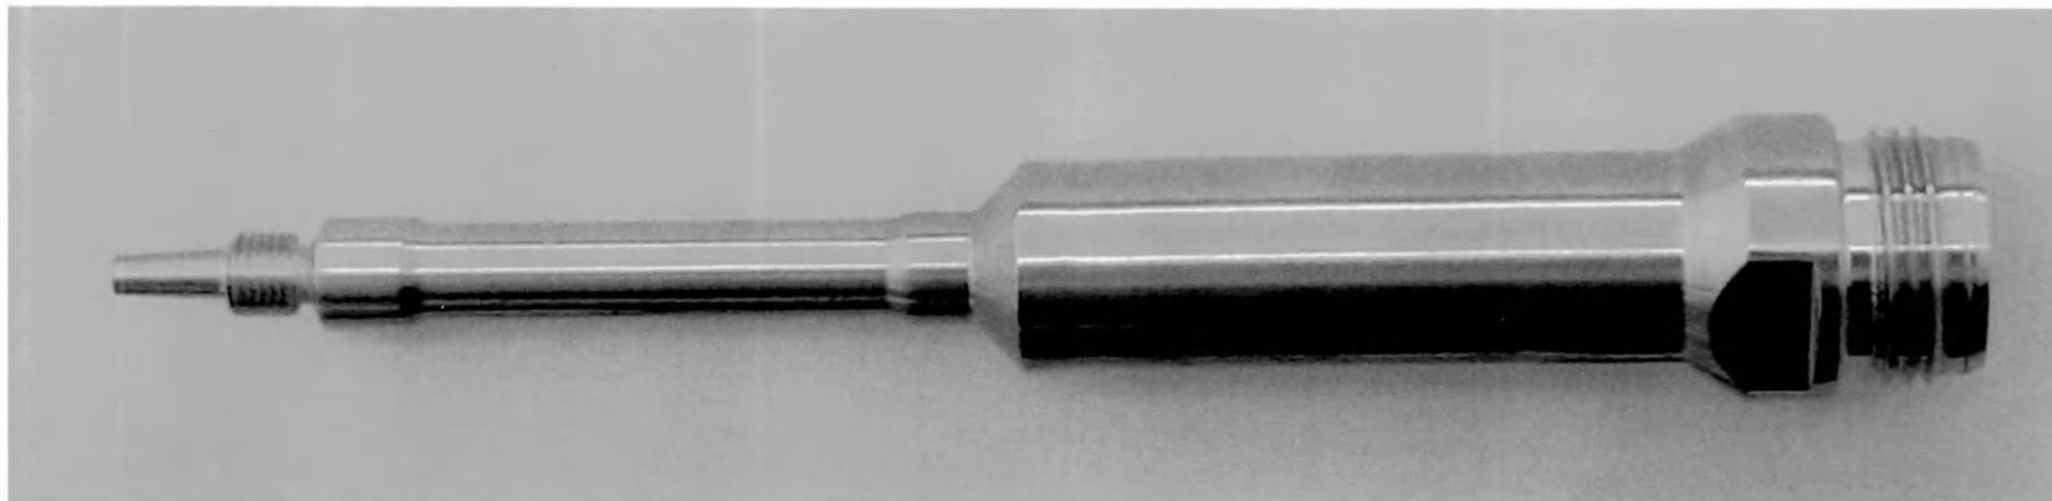

Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 5

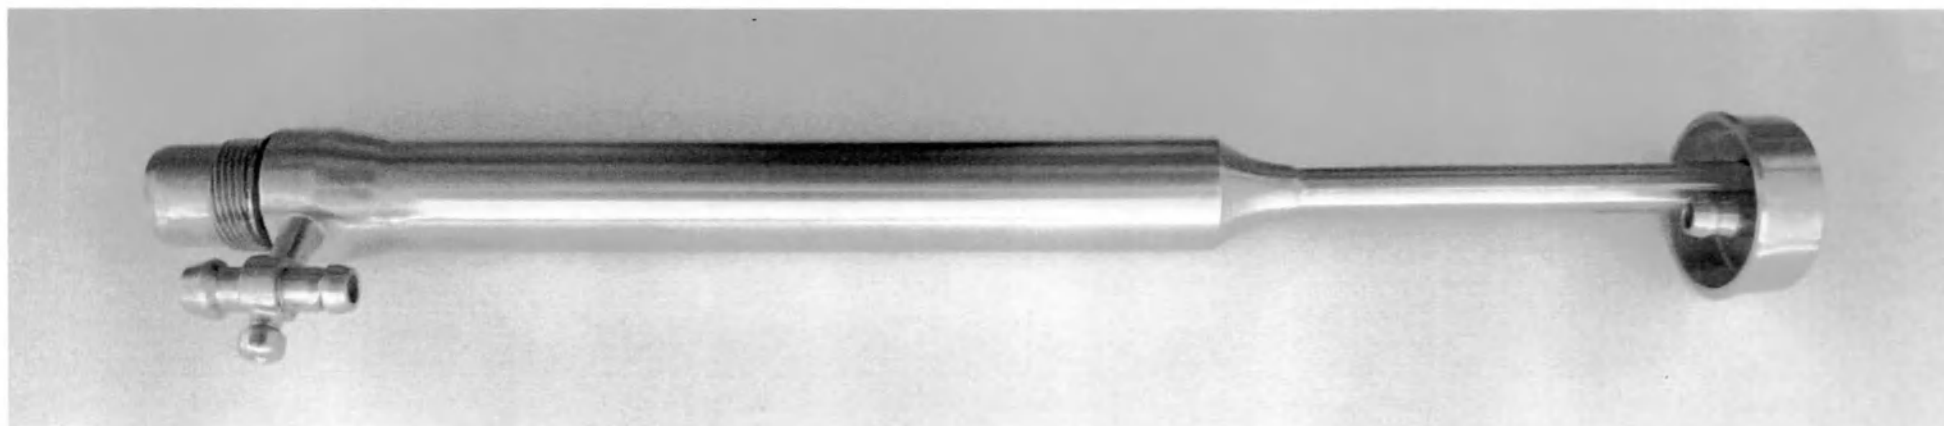


Кожух сменный для узла акустического ультразвукового. Исполнение 6

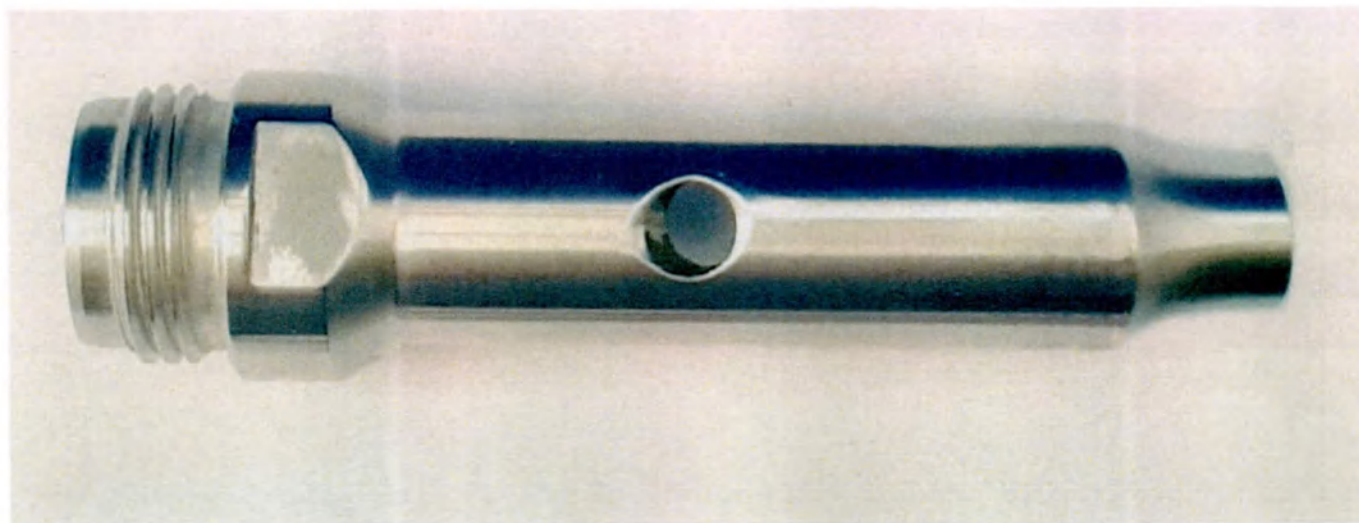


Наконечник сменный для подключения к коже. Исполнение 1

Типоразмер 1

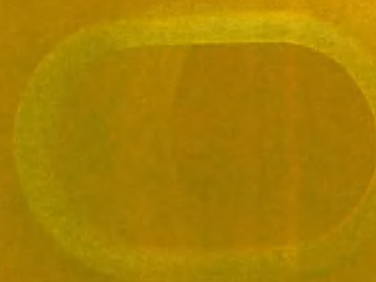

Типоразмер 2

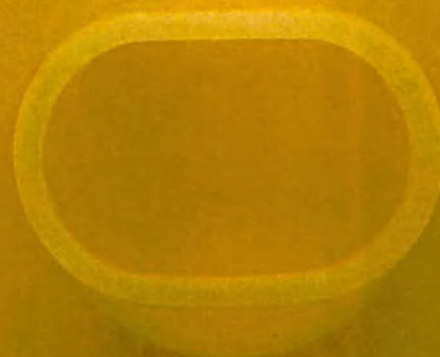


Типоразмер 3




Наконечник сменный для подключения к кожуху. Исполнение 2. Типоразмер 1



Наконечник сменный для подключения к кожуху. Исполнение 2. Типоразмер 2

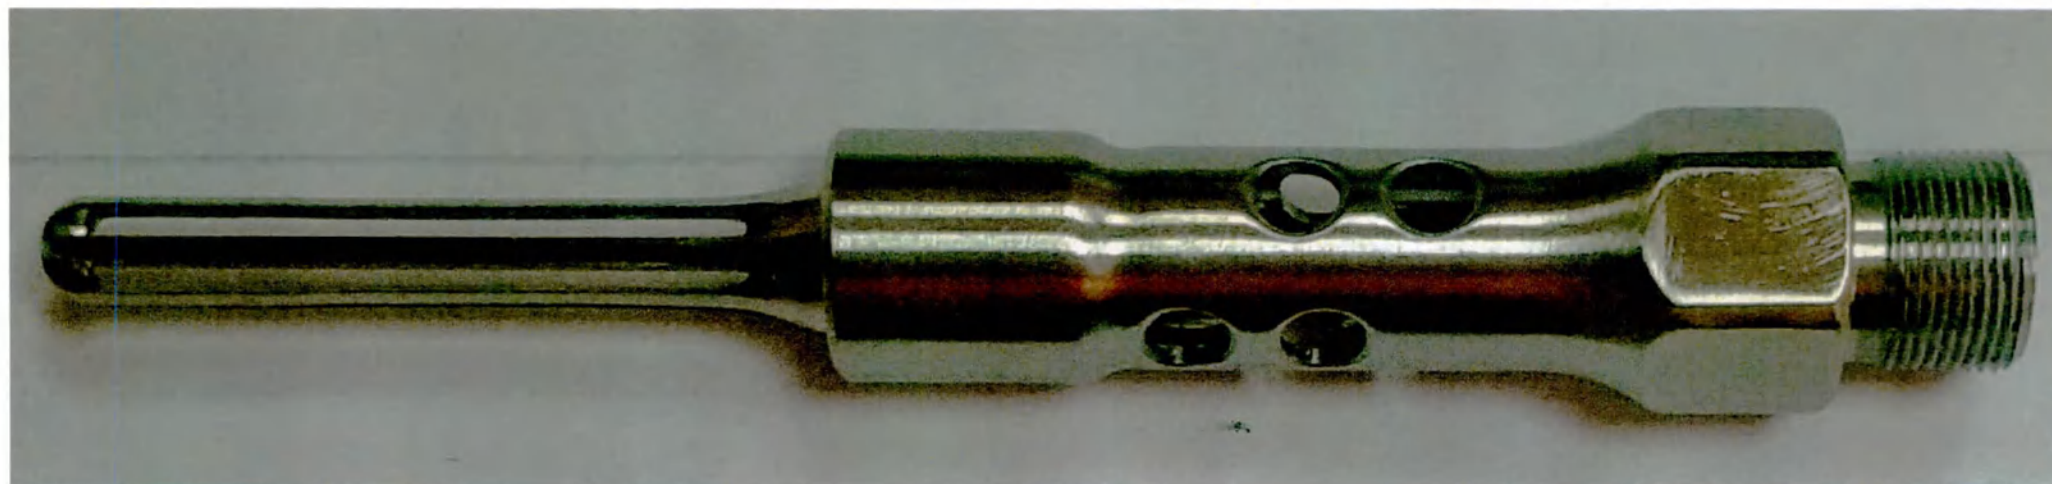

Наконечник сменный для подключения к кожуху. Исполнение 2. Типоразмер 3

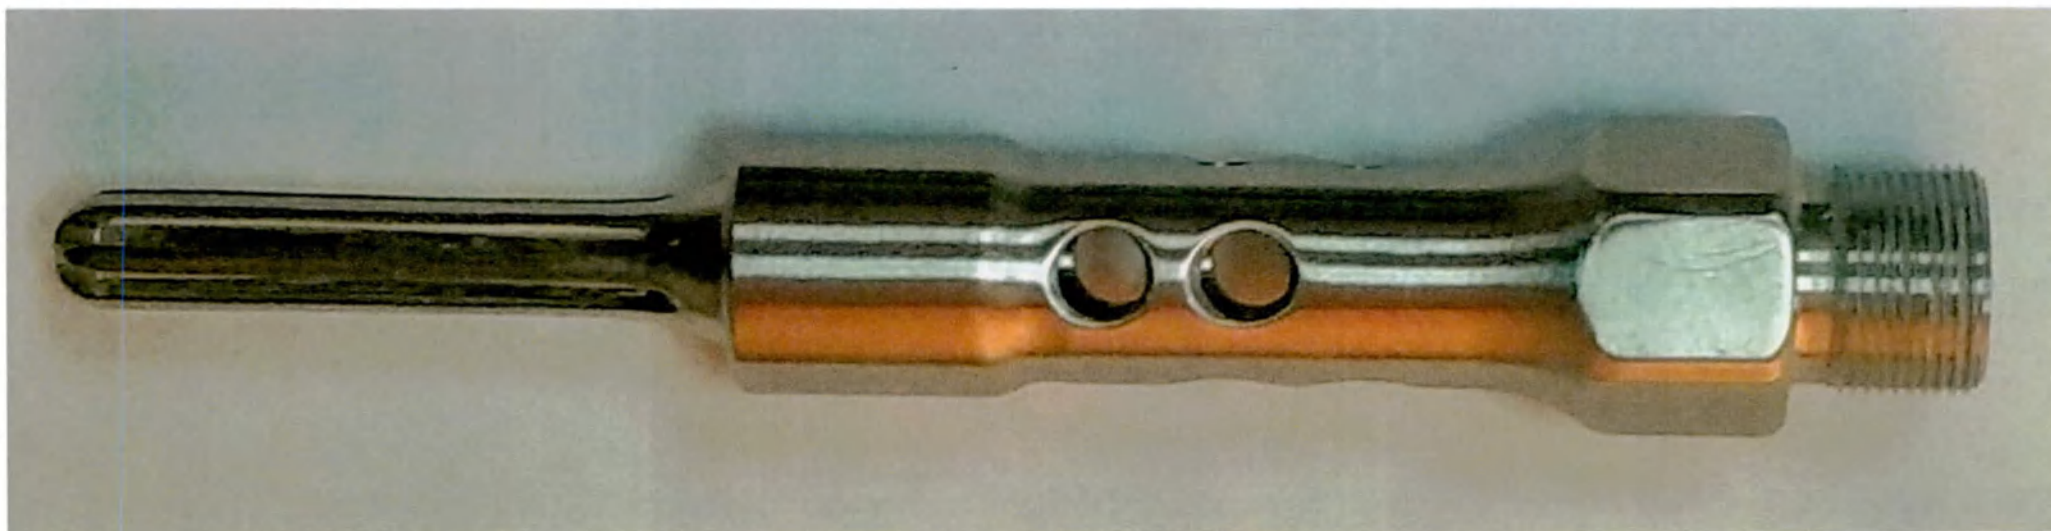

Наконечник сменный для подключения к кожуху. Исполнение 3



Переходник-адаптер для подключения узла акустического

Исполнение 1




Исполнение 2



Банка для аспирации с крышкой




Набор шлангов для аспирации

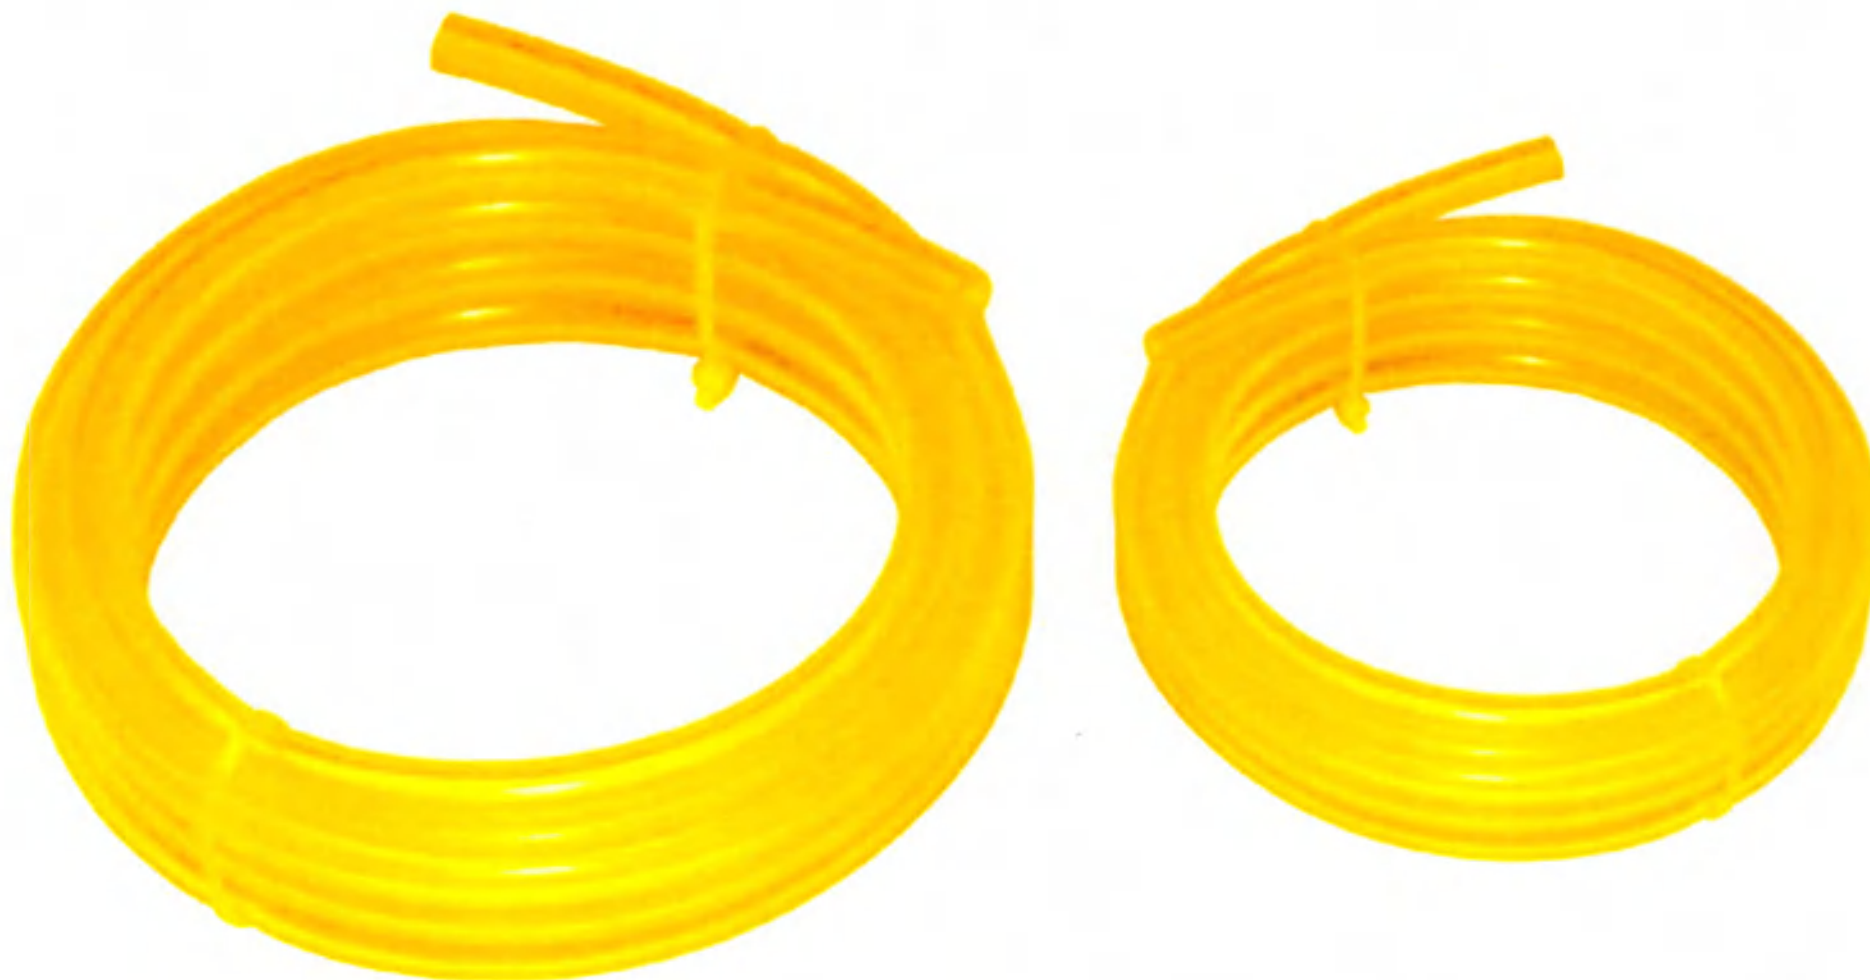


Шланг. Исполнение 1



Шланг. Исполнение 2

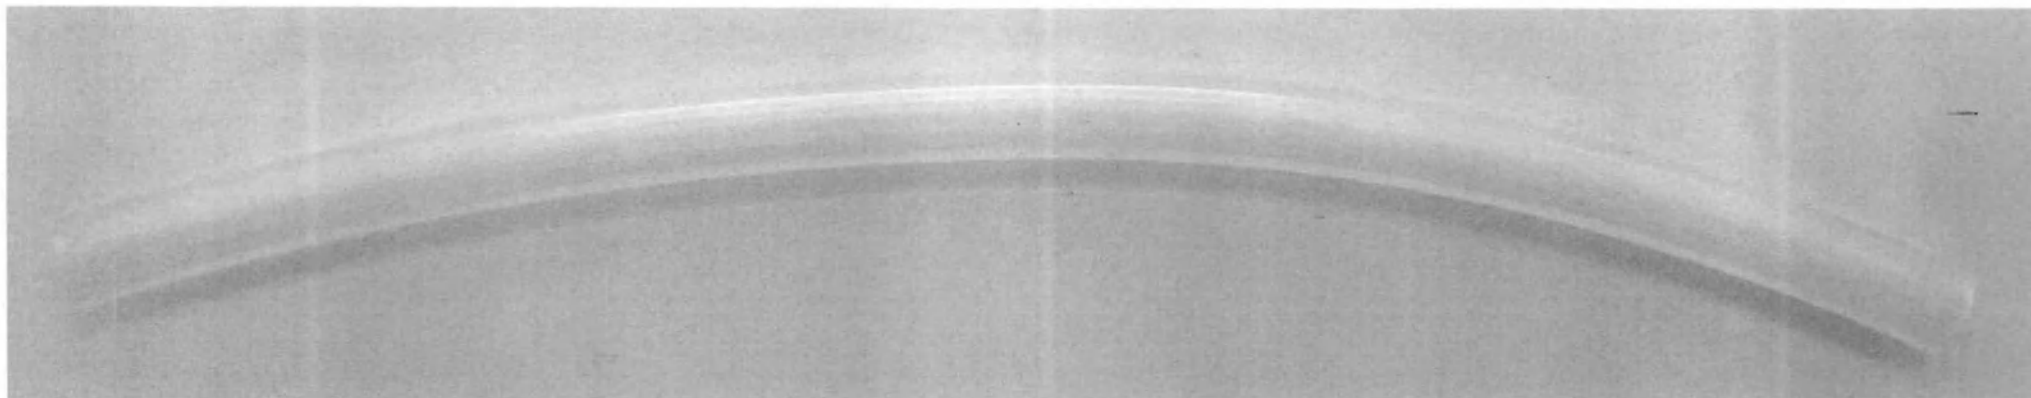

Шланг. Исполнение 3

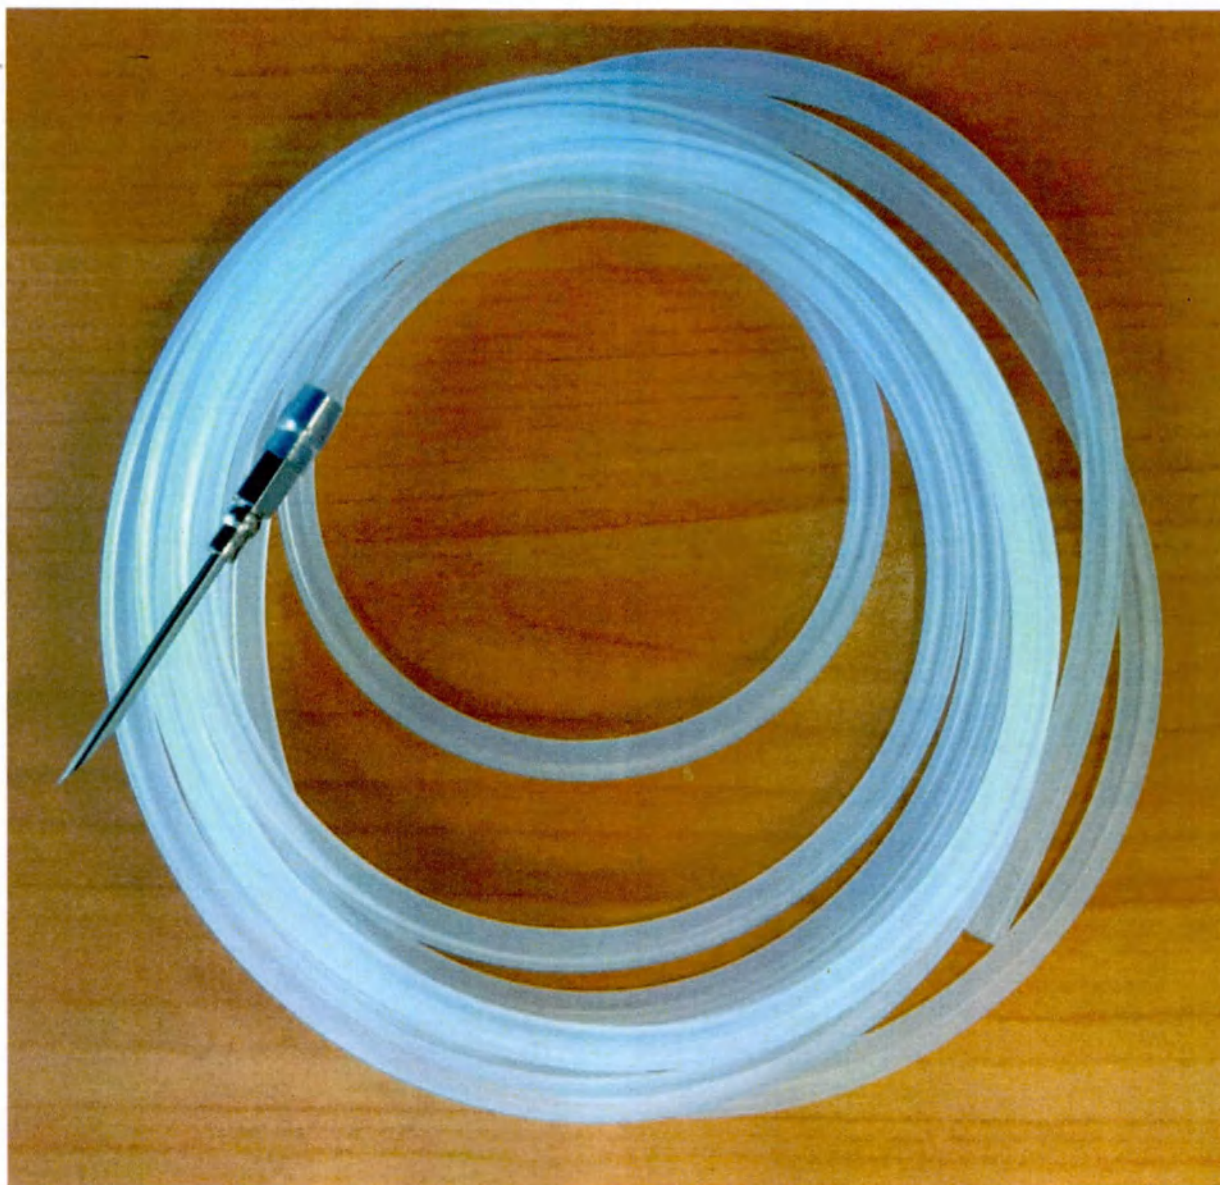

Наконечник аспирационный. Исполнение 1



Наконечник аспирационный. Исполнение 2




Ключ для фиксации инструментов. Исполнение 1



Ключ для фиксации инструментов. Исполнение 2



Ручка для узла акустического ультразвукового

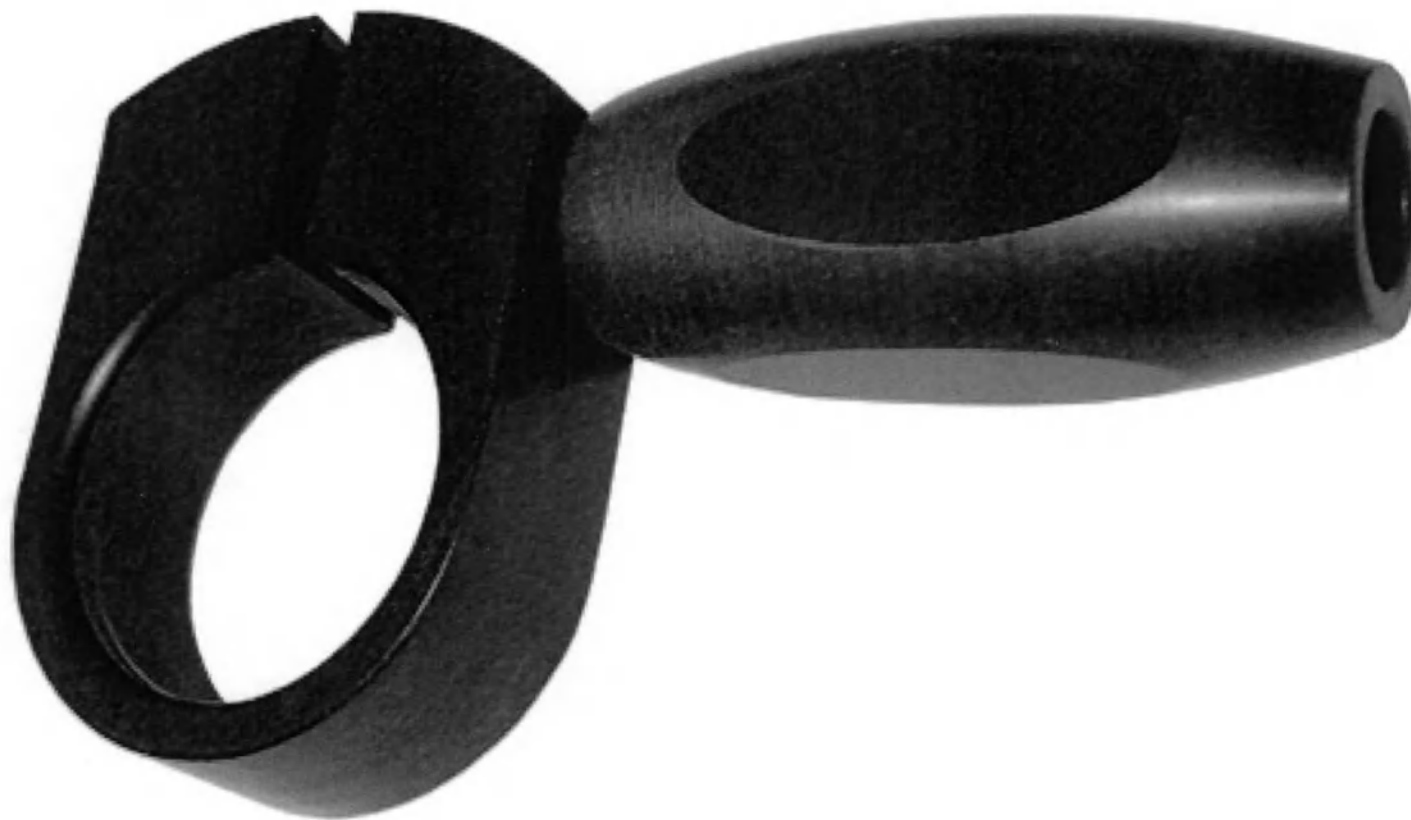

Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов (5 шт.). Исполнение 1




Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов (5 шт.). Исполнение 2



Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» по ТУ 9452-001-41747567-2015, вариант исполнения: стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК»
ООО "ФОТЕК", Россия РУ от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790



Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" в упаковке

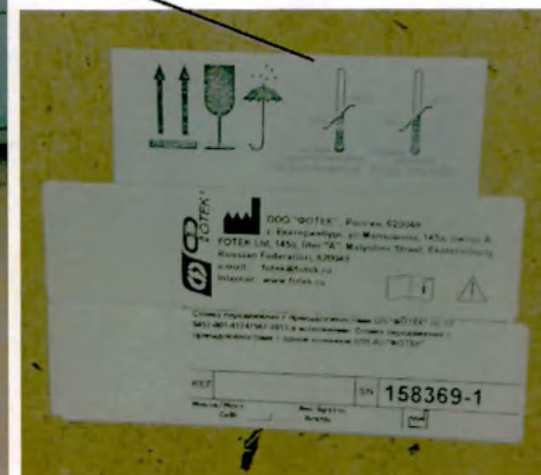


Шнур питания



Предохранитель 5 x 20мм, 250В, F 3А



Элемент питания CR123, 3 В

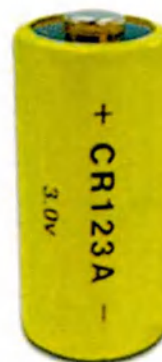


Изделия медицинские полимерные – катетеры. Катетер урологический (катетер Нелатона), размерный ряд от 6 до 20 Fr, с шагом 2 Fr

Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД, Китай, РУ от 24.12.2008 № ФСЗ 2008/03465




Катетеры урологические APEXMED: Фолея, Нелатона, наружный мужской, урологический женский
"Апексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды, РУ от 19.11.2008, № ФСЗ 2008/02858

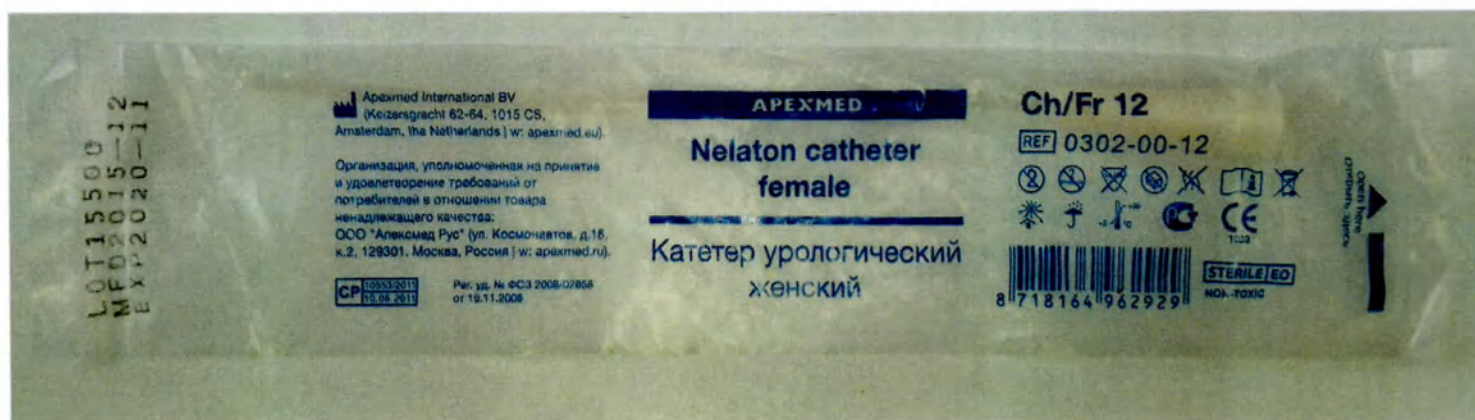

Катетеры одноразовые урологические Нелатона, Фолея

"Хайянь Канджин Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ от 29.11.2018 № ФСЗ 2011/10794

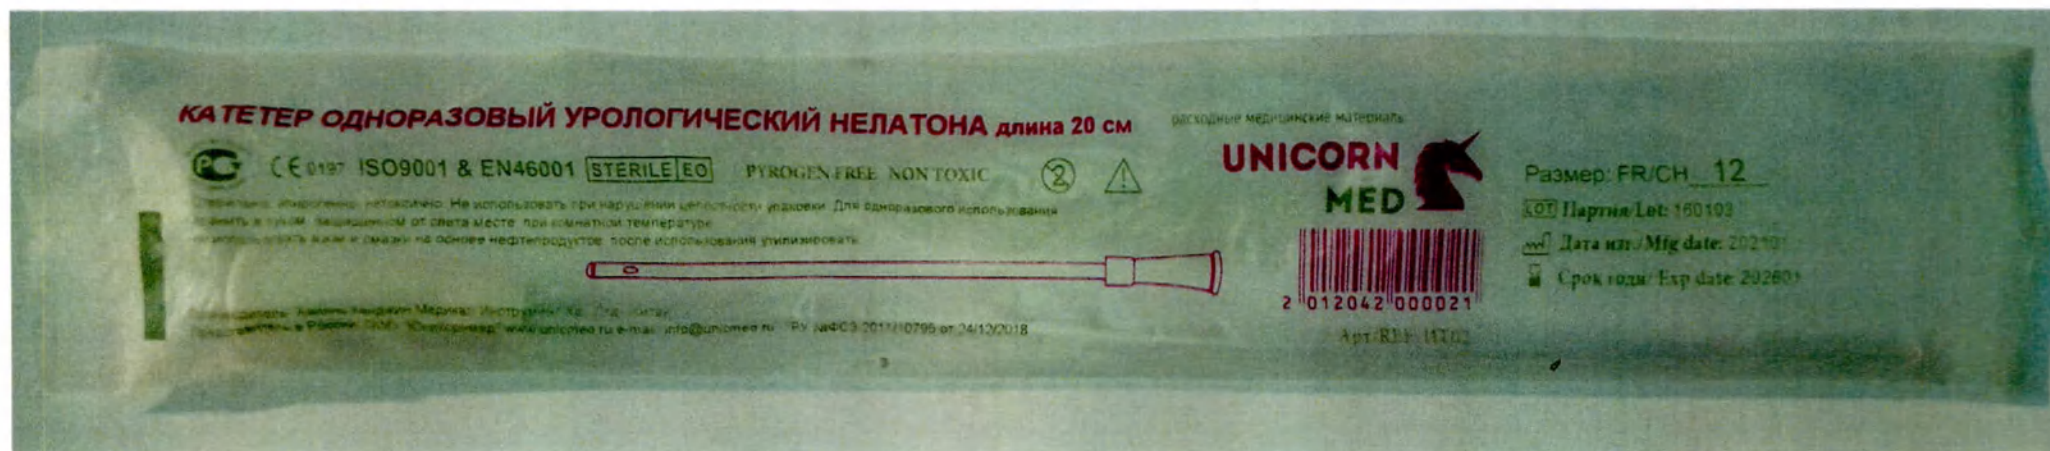

Б. Браун Мельзунген АГ, Германия, РУ от 16.12.2021 № ФСЗ 2007/00004



Устройства для инфузионно-трансфузионной терапии (магистраль и коннекторы). Коннекторы с возвратным клапаном

Б. Браун Мельзунген АГ, Германия, РУ от 19.08.2015 № ФСЗ 2007/00002



Наконечники стоматологические для аспирации слюны и фракций при обработке зубов Dispodent

"ДЕНТОПЛАСТ с.а.р.л.", Ливан, РУ от 26.03.2009, № ФСЗ 2009/04069




JNB Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций при обработке зубов: JNB Слюноотсосы

"Шанхай Дочем Индастриз Ко., Лтд.", Китай, РУ от 23.10.2009 № ФСЗ 2009/04348




Изделия для индивидуальной защиты врача и пациента Monoart: наконечники для аспирации слюны и фракции Monoart

ЕУРОНДА С.п.А., Италия, РУ от 08.04.2022 № ФСЗ 2011/09468

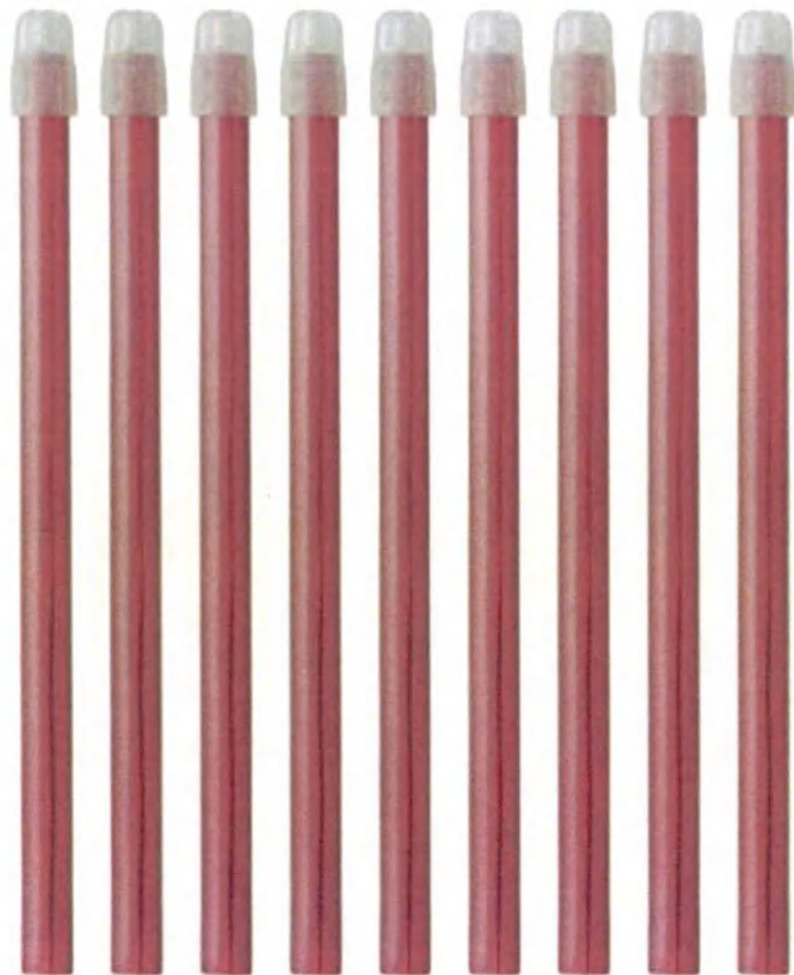

Приспособления для отсасывания Nitex: отсасывающий наконечник янкаер Nitex

"Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А.С.", Турция, РУ от 22.02.2017 № ФСЗ 2008/00074

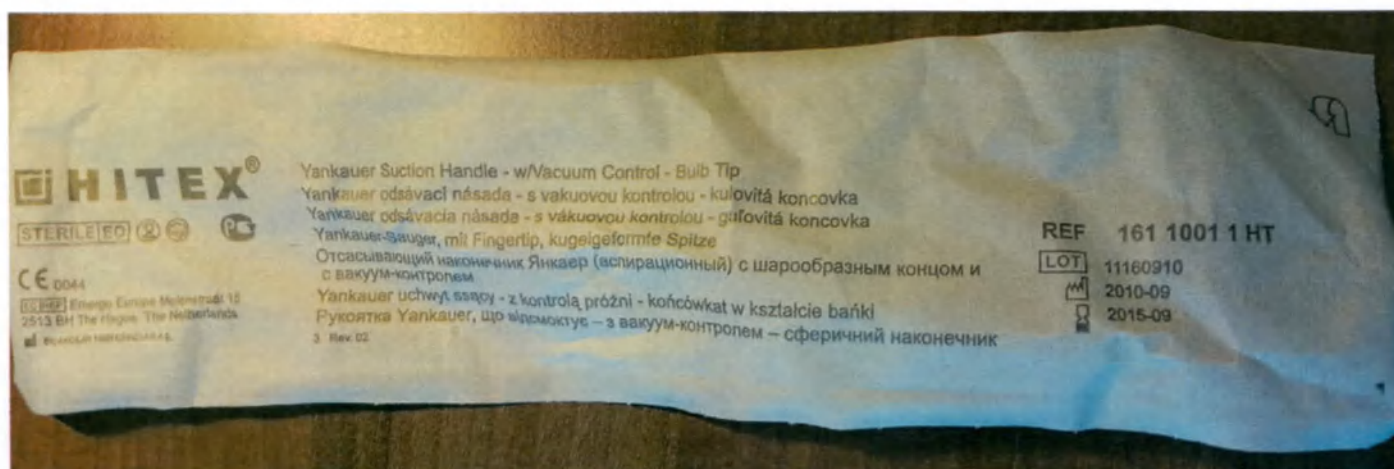

Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями: Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках. Трубка аспирационная, тип Янкувера.

"СУМИ Сп. з о.о. сп.к.", Польша, РУ от 19.09.2017 № ФСЗ 2011/10986.



Изделия одноразовые для хирургии: канюли аспирационные (вид 169600): Янкувера жесткая, Янкувера жесткая с наконечником BULB, Янкувера стандартная, Янкувера с трубкой.


"Грена Лтд.", Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. РУ от 27.06.2022 № ФСЗ 2008/02014



Инструменты колющие по ТУ 9432-294-07610776-2011 в следующих исполнениях:

- игла Куликовского для прокола гайморовой полости;
- игла Куликовского для прокола гайморовой полости (Луер).

ОАО "МИЗ-Ворсма", Россия, РУ от 05.07.2011 № ФСР 2009/05085

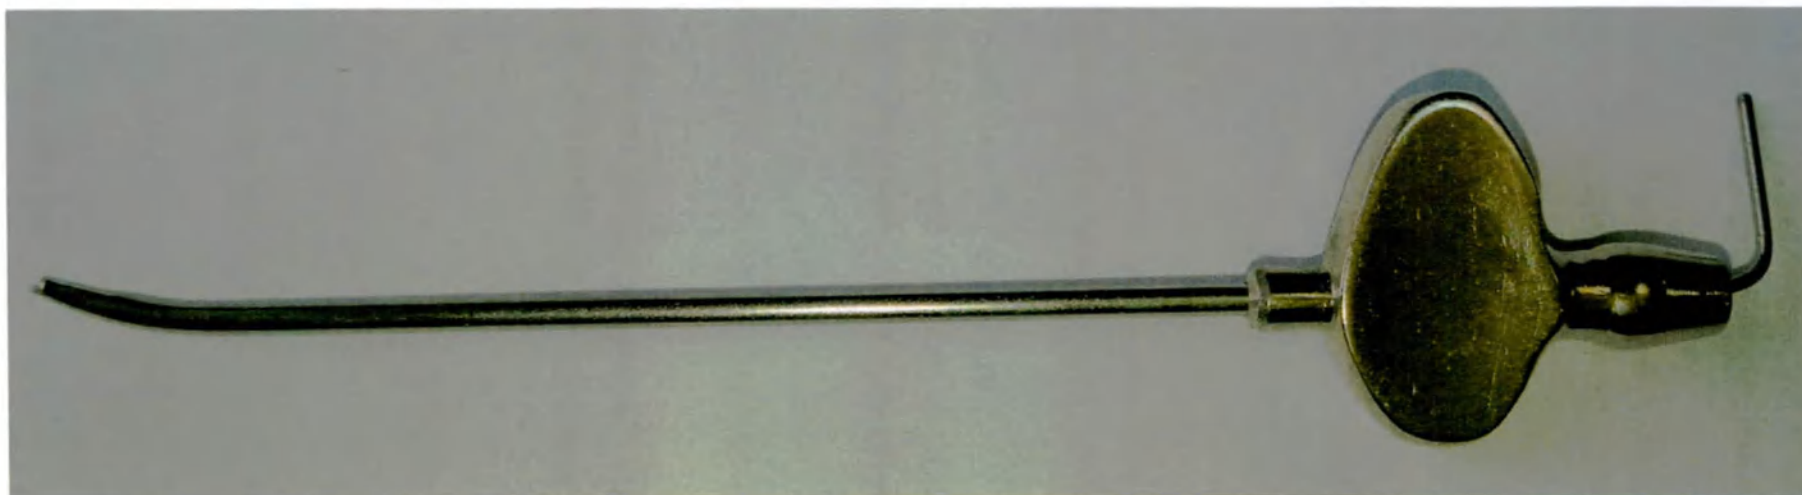

Банка аспирационная Элема-Н БП2500 с кронштейном на шину

ООО "Элема-Н", Россия



Система внутривенного введения для инфузионных насосов VL ST10 standard + RLL + SF.

"Фрезениус Каби АГ", Германия. РУ от 25.04.2024 № ФСЗ 2010/07218



Фотографическое изображение упаковки



Прошито и пронумеровано 73
(семьдесят три) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"

А.В.Малеев



УТВЕРЖДАЮ




Маркировка медицинского изделия
Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК»
по ШГИД.941629.001ТУ


1. Маркировка блока управления аппарата
- 1.1 Маркировка передней панели блоков управления аппарата:



1.2 Маркировка выходов блоков управления аппарата на передней панели:

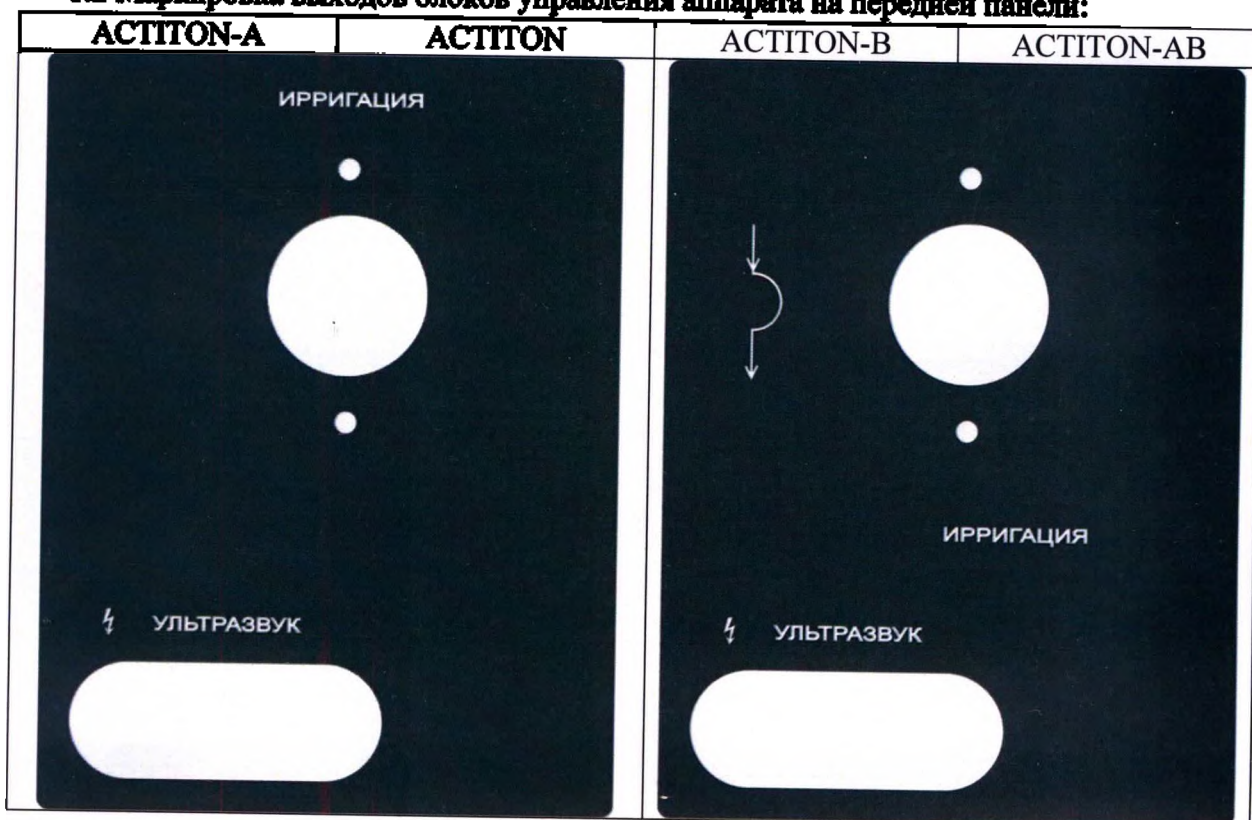

1.3 Маркировка выключателя «STB»



1.4 Маркировка перистальтического насоса



1.5 Основная маркировка задней стенки блока управления

АСТІТОН

Аппарат ультразвуковой хирургический
кавитационный «ФОТЕК» по ШГИД.941629.001ТУ
Модель «АСТІТОН»
Блок управления АСТІТОН
РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN 



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, номер А
<https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60 Гц, 270 В·А


 IPX1

Режим работы: 1 мин - активация, 2 мин - пауза

АСТІТОН-А

Аппарат ультразвуковой хирургический
кавитационный «ФОТЕК» по ШГИД.941629.001ТУ
Модель «АСТІТОН-А»
Блок управления АСТІТОН-А
РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN 



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, номер А
<https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60 Гц, 270 В·А


 IPX1

Режим работы: 1 мин - активация, 2 мин - пауза

АСТІТОН-В

Аппарат ультразвуковой хирургический
кавитационный «ФОТЕК» по ШГИД.941629.001ТУ
Модель «АСТІТОН-В»
Блок управления АСТІТОН-В
РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN 



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, номер А
<https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60 Гц, 270 В·А


 IPX1

Режим работы: 1 мин - активация, 2 мин - пауза

АСТІТОН-АВ

Аппарат ультразвуковой хирургический
кавитационный «ФОТЕК» по ШГИД.941629.001ТУ
Модель «АСТІТОН-АВ»
Блок управления АСТІТОН-АВ
РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN 




ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, номер А
<https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60 Гц, 270 В·А



 IPX1

Режим работы: 1 мин - активация, 2 мин - пауза

1.6 Маркировка места присоединения педалей на задней стенке блока управления аппарата



1.7 Маркировка места расположения, схематического обозначения, типа и номинала предохранителей

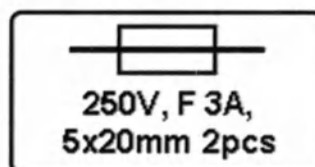

1.8 Маркировка места подключения аспирационного шланга (только для аппарата моделей «АСТІТОН-А» и «АСТІТОН-АВ»)




1.9 Маркировка сетевого выключателя



1.10 Маркировка на нижней панели блока управления аппарата

ACTITON

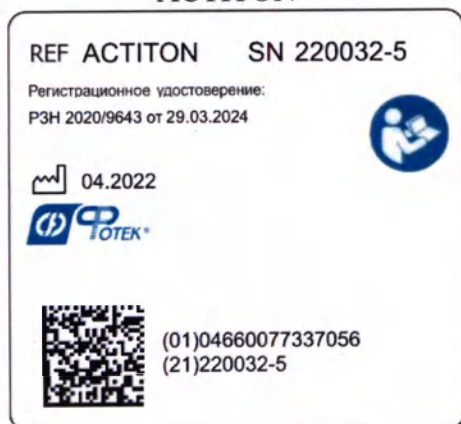

ACTITON-A



ACTITON-B



ACTITON-AB



2. Маркировка педалей:


2.1 Маркировка на верхней панели педали



2.2 Маркировка одноклавишной и двухклавишной педалей



2.3 Маркировка одноклавишной и двухклавишной беспроводных педалей

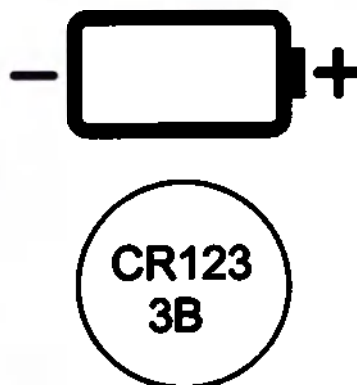

2.4 Маркировка инструментов и шнура питания

REF EP001

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024



 04.2022

 Партия (LOT)
0000098568

 (01)04660077335281
(10)98568

REF AA201.5 SN 22097


Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024



 06.2022

 (01)04660077336998
(21)22098

1. Маркировка транспортной тары

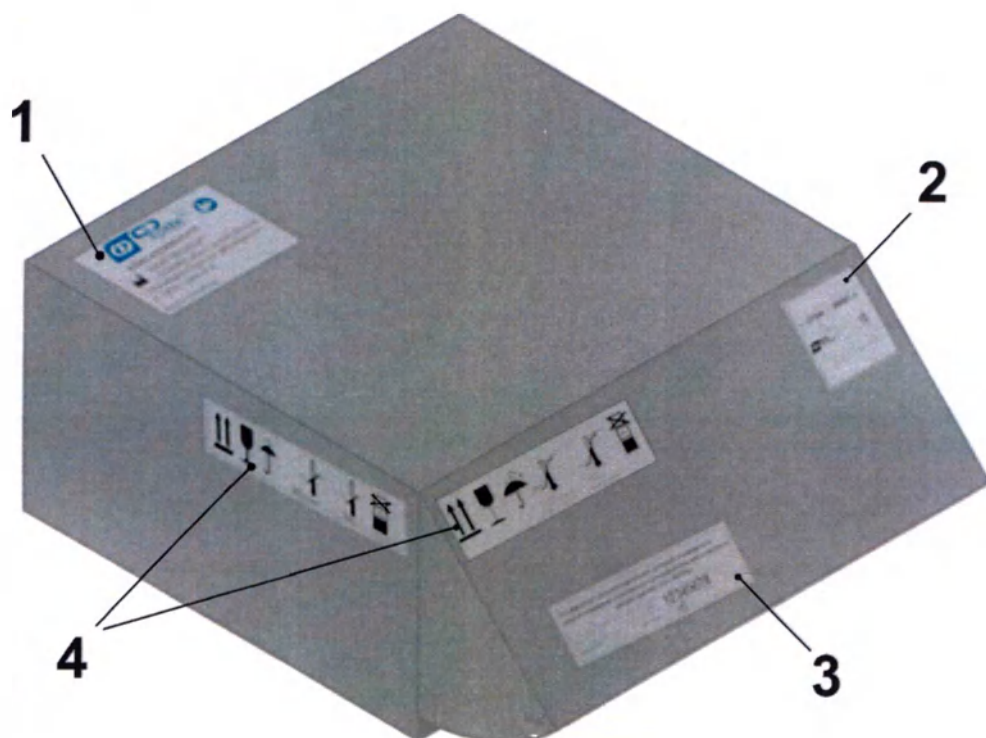

1



ACTITON

REF ACTITON SN 220032-5

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

 04.2022



 (01)04660077337056
(21)220032-5

ACTITON-A

REF ACTITON-A SN 220137-5

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

 04.2022



 (01)04660077337063
(21)220137-5

ACTITON-B

REF ACTITON-B SN 220001-1

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

 08.2022



 (01)04660077337979
(21)220001-1

ACTITON-AB

REF ACTITON-AB SN 220001-1

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

 08.2022



 (01)04660077337977
(21)220001-1

3

АСТІТОН-А:

Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК»
по ШГИД.941629.001ТУ. Модель «АСТІТОН-А»

РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN

Место/Мест

/

Масса брутто



АСТІТОН:

Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК»
по ШГИД.941629.001ТУ. Модель «АСТІТОН»

РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN

Место/Мест

/

Масса брутто



АСТІТОН-В:

Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК»
по ШГИД.941629.001ТУ. Модель «АСТІТОН-В»

РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN

Место/Мест

/

Масса брутто



АСТІТОН-АВ:

Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный «ФОТЕК»
по ШГИД.941629.001ТУ. Модель «АСТІТОН-АВ»

РУ № РЗН 2020/9643 от 29.03.2024

SN

Место/Мест

/

Масса брутто



