



Амплипульс-5ДС АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

5 3 4 1 2 род работы	75 100 >100 0 25 50 модуляция %	150 50 80 100 10 20 30 частота модуляции, Hz	1:1.5 2:3 4:6 длительность S	10 20 100 ток пациента	режим электроды/контроль
--	---	--	--	--------------------------------------	--


Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5ДС» по ТУ 9444-004-75620370-2015 (вид спереди)

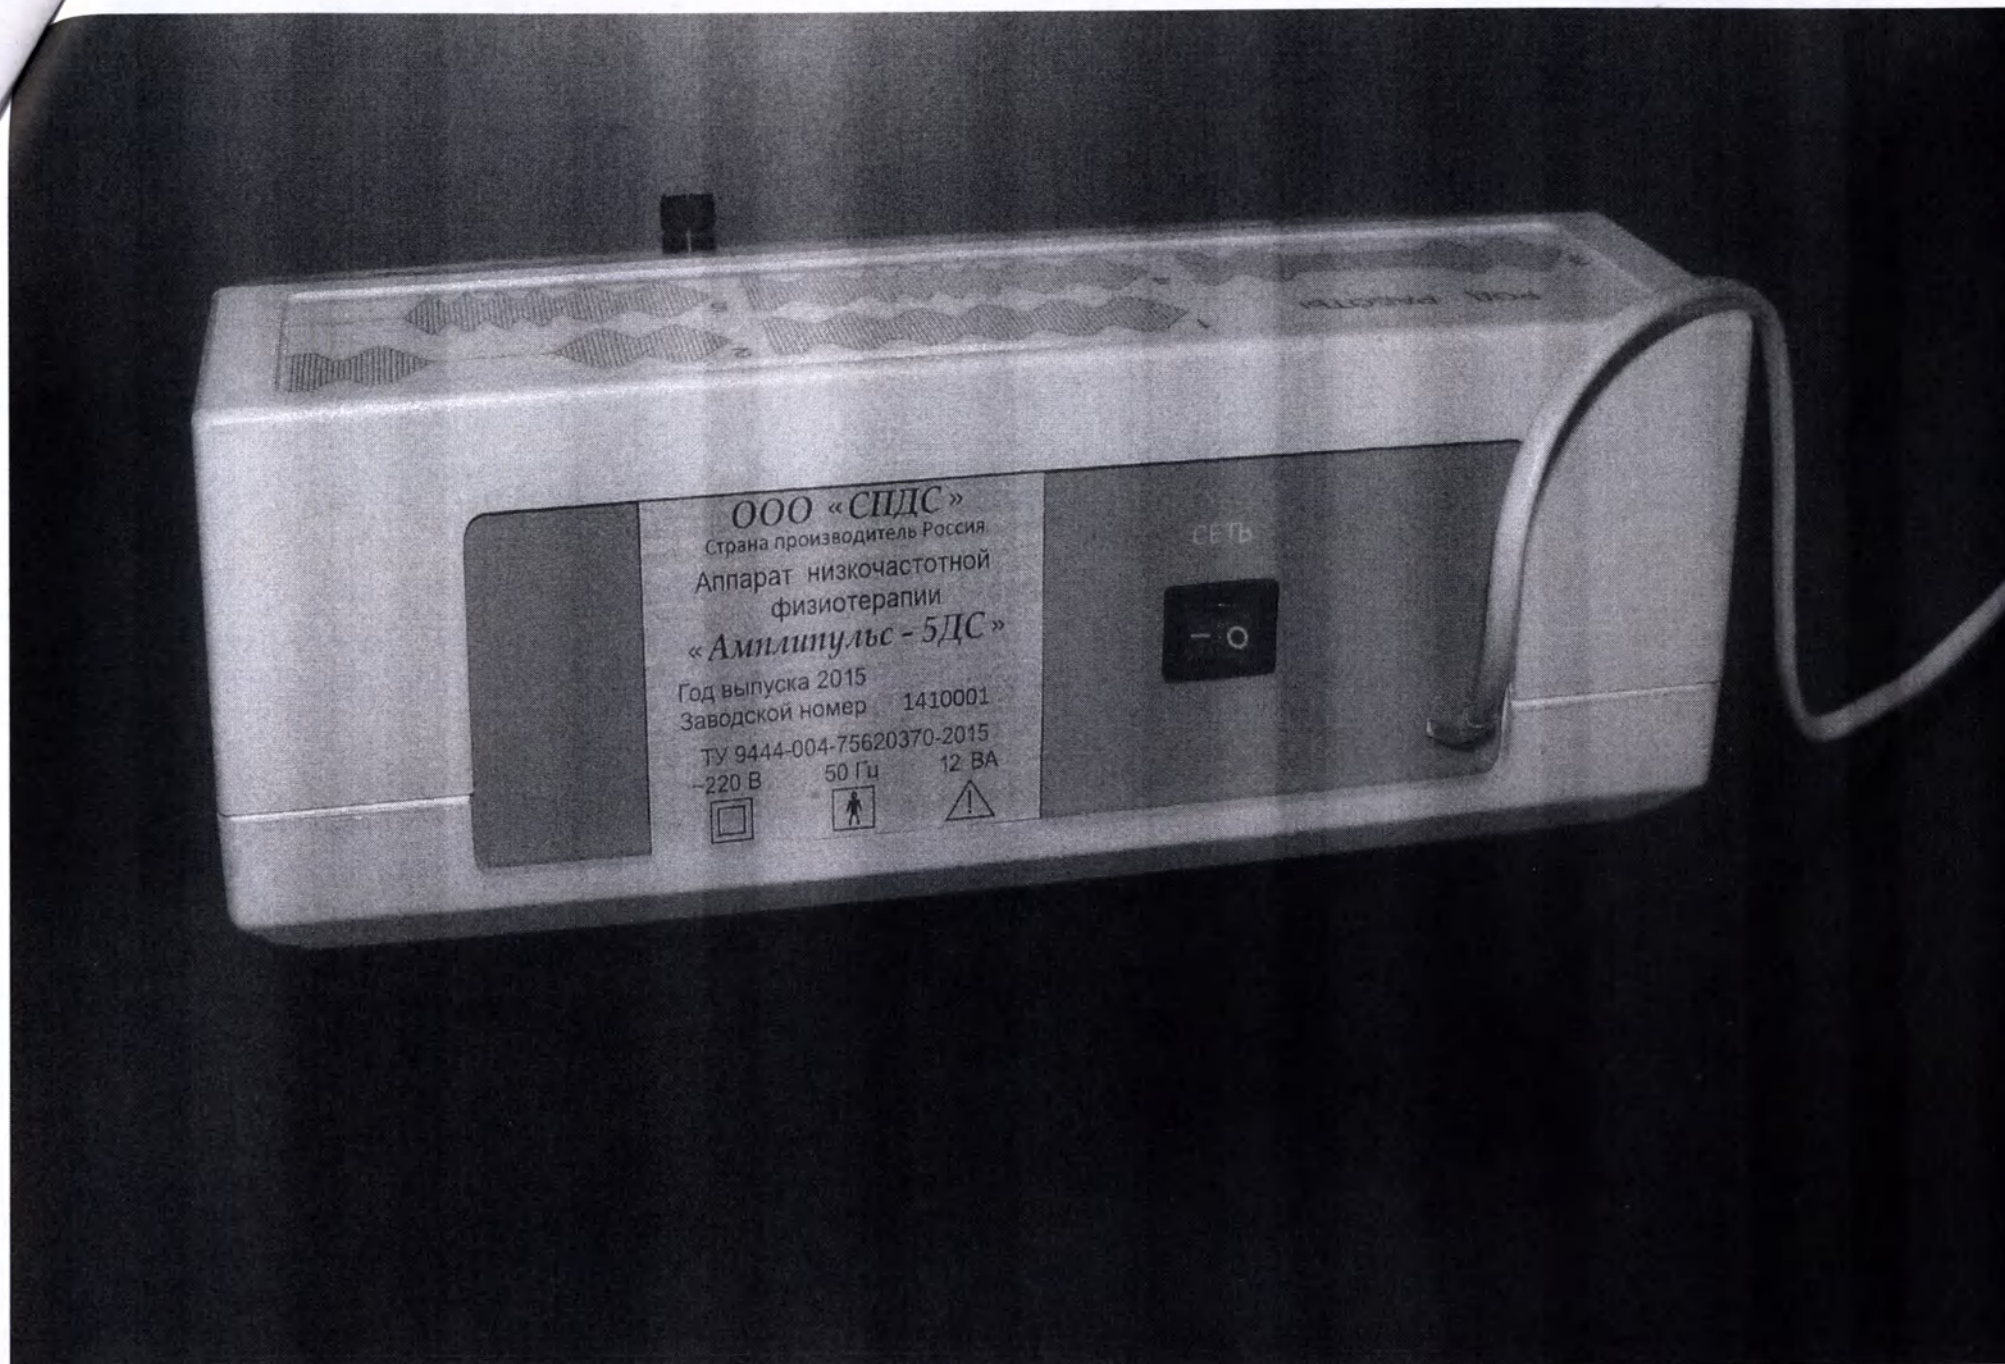


Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5ДС» по ТУ 9444-004-75620370-2015 (вид сзади)

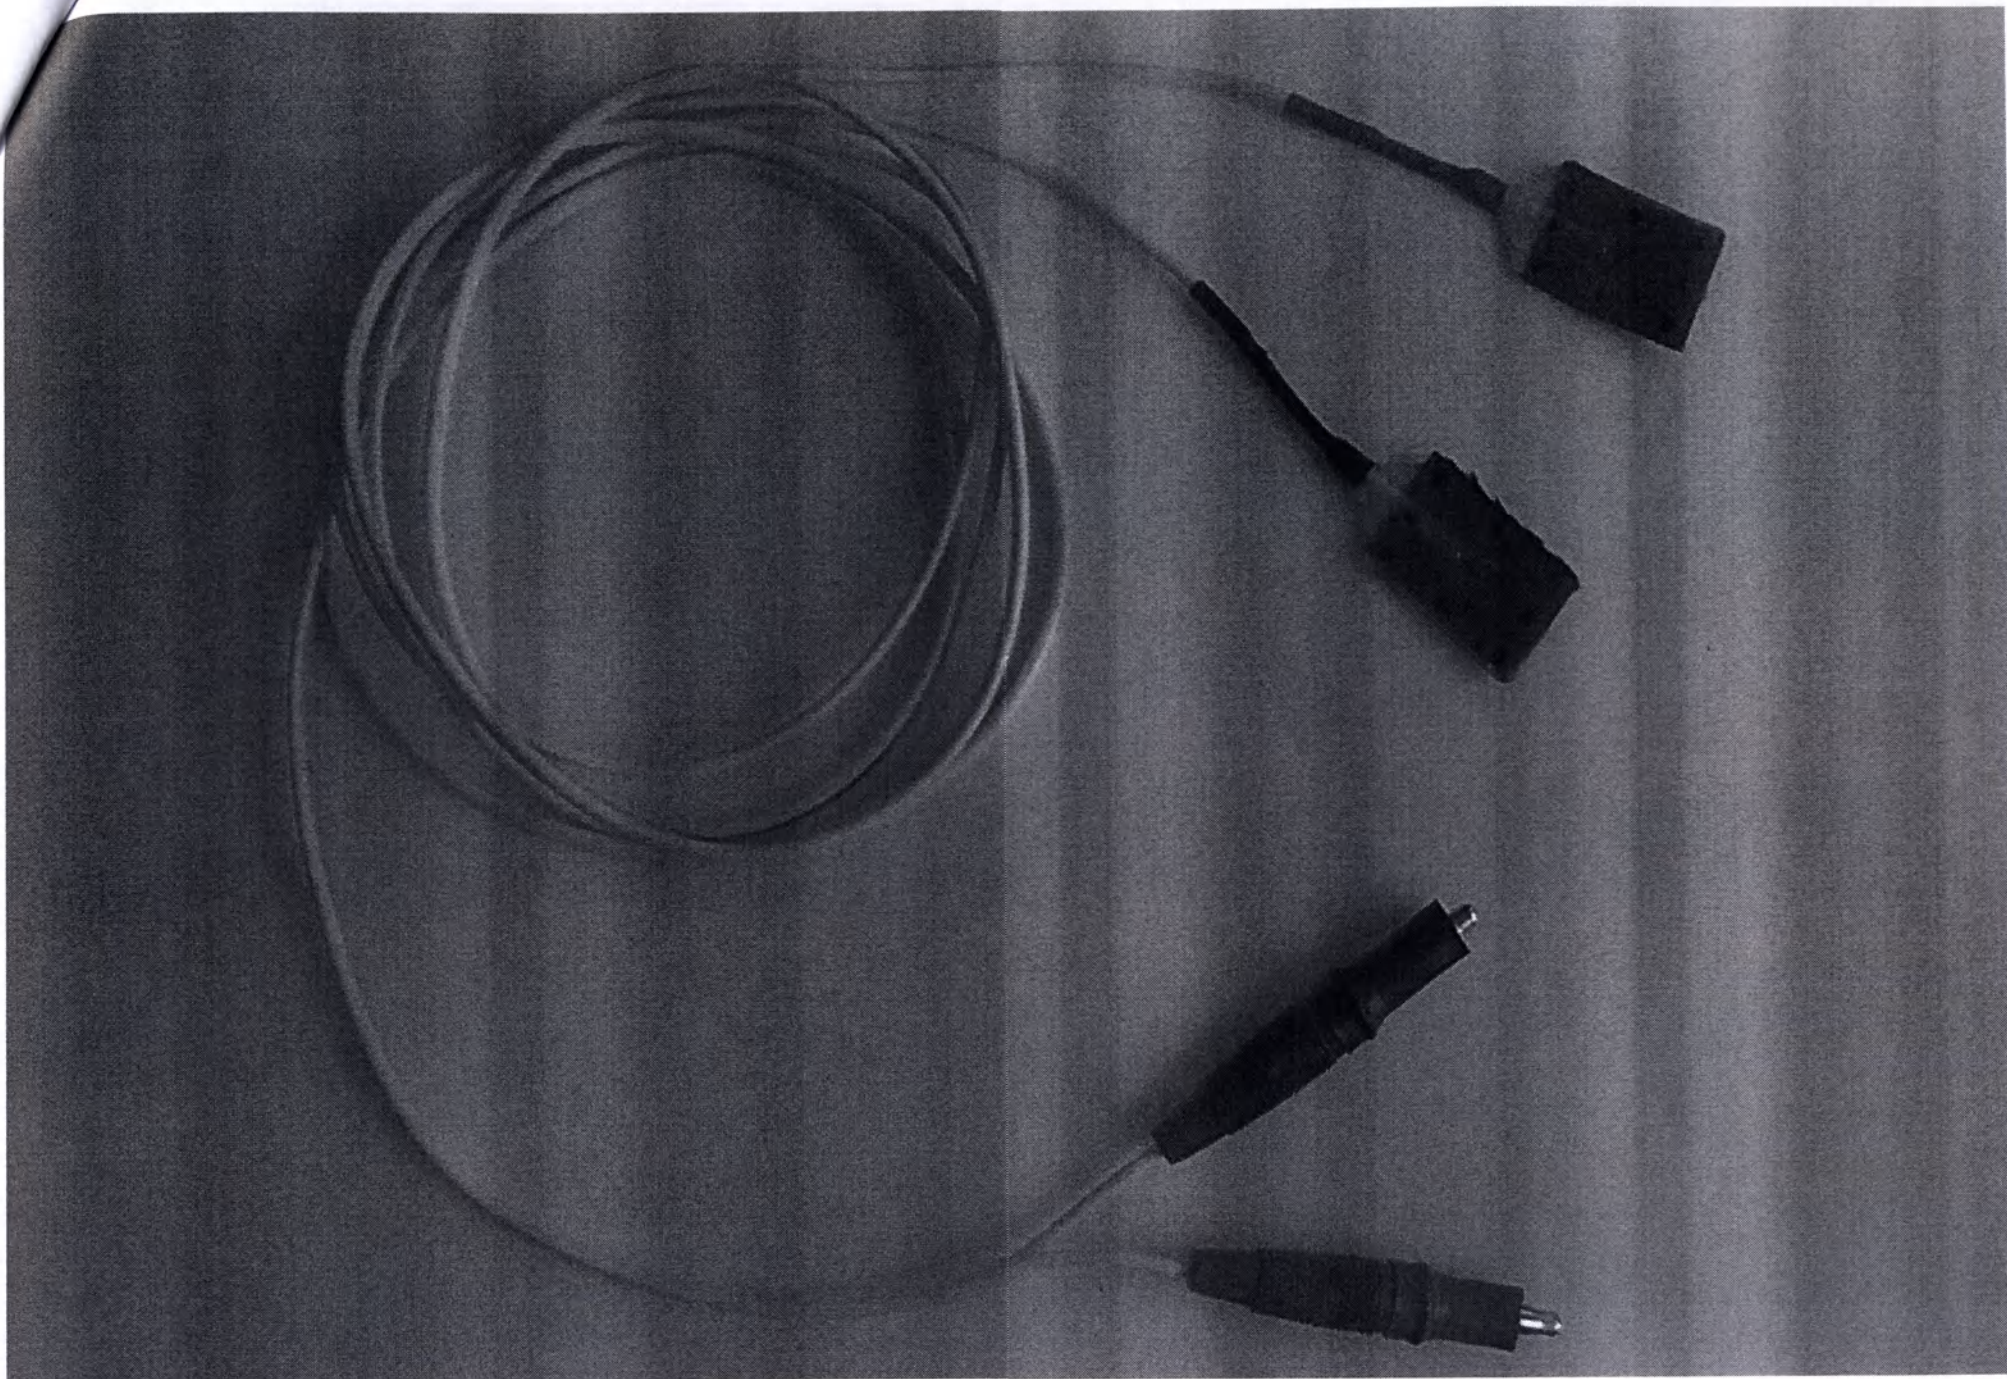


Кабель для присоединения электродов №1

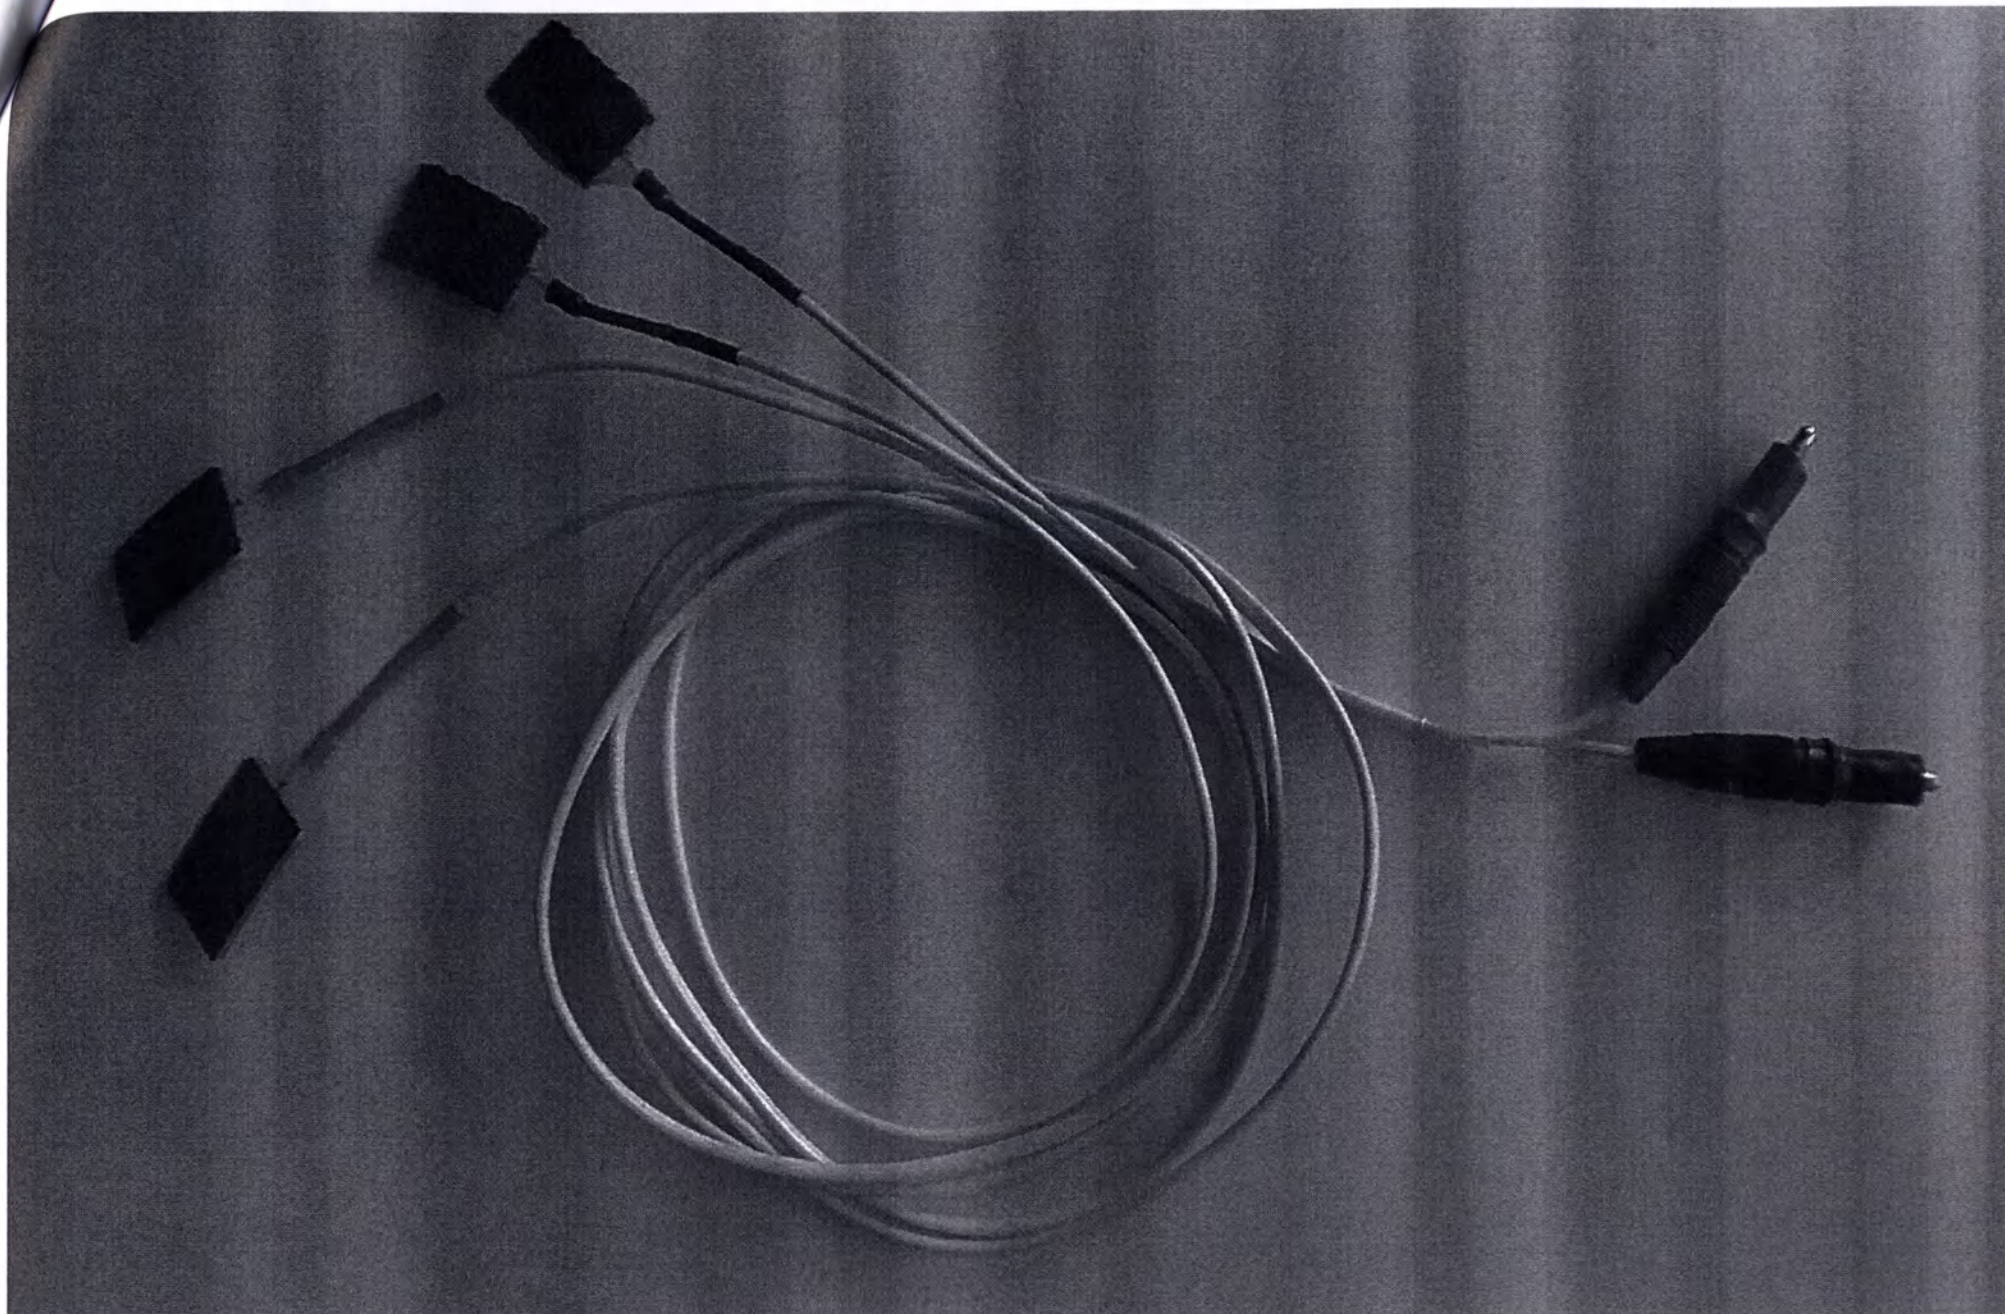

Кабель для присоединения электродов №2

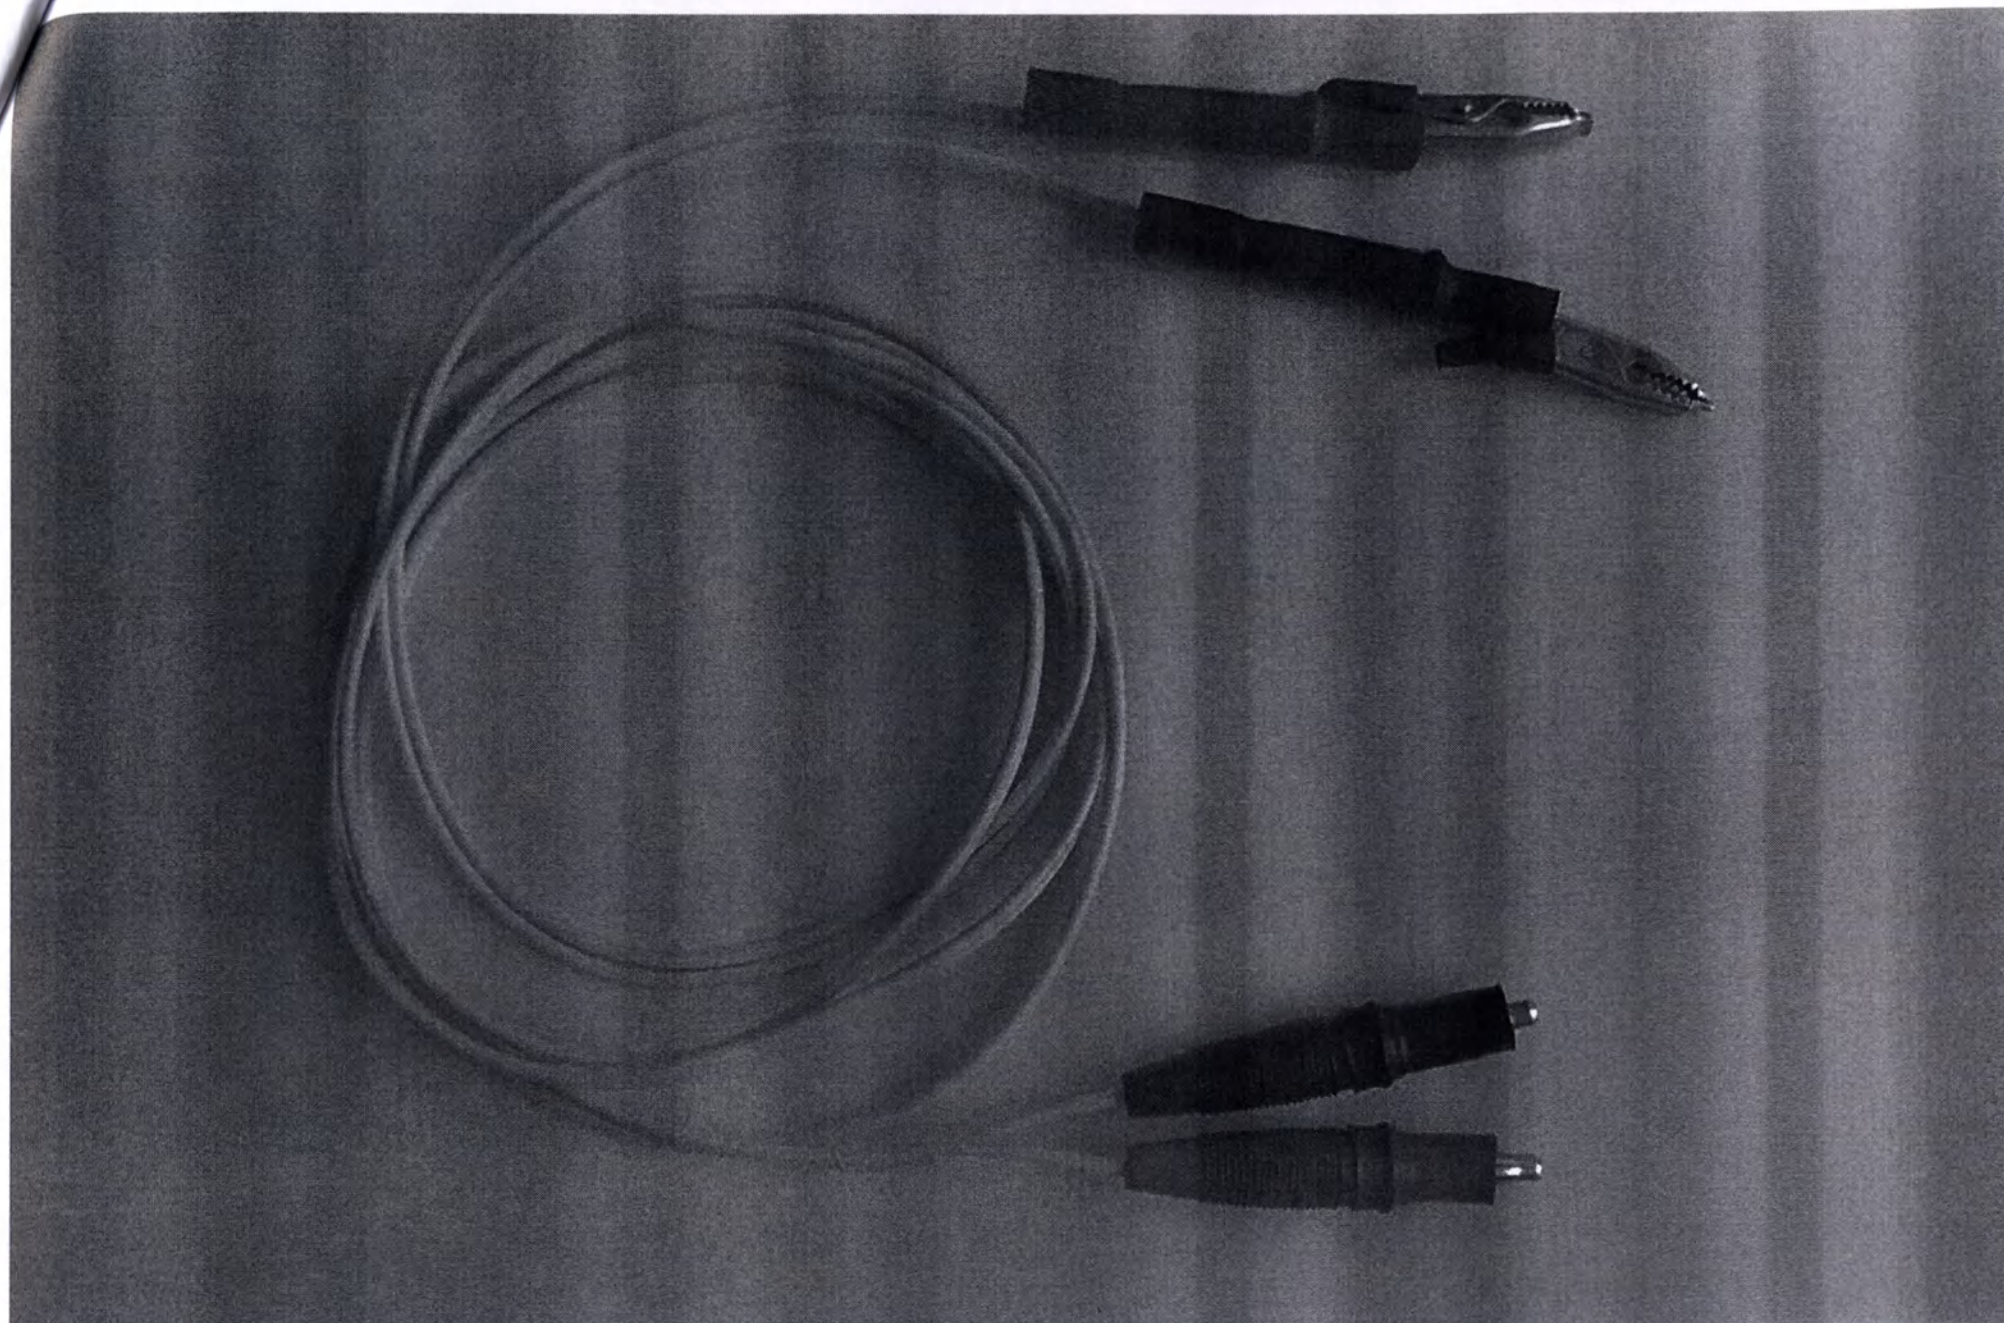


Кабель для присоединения электродов №3

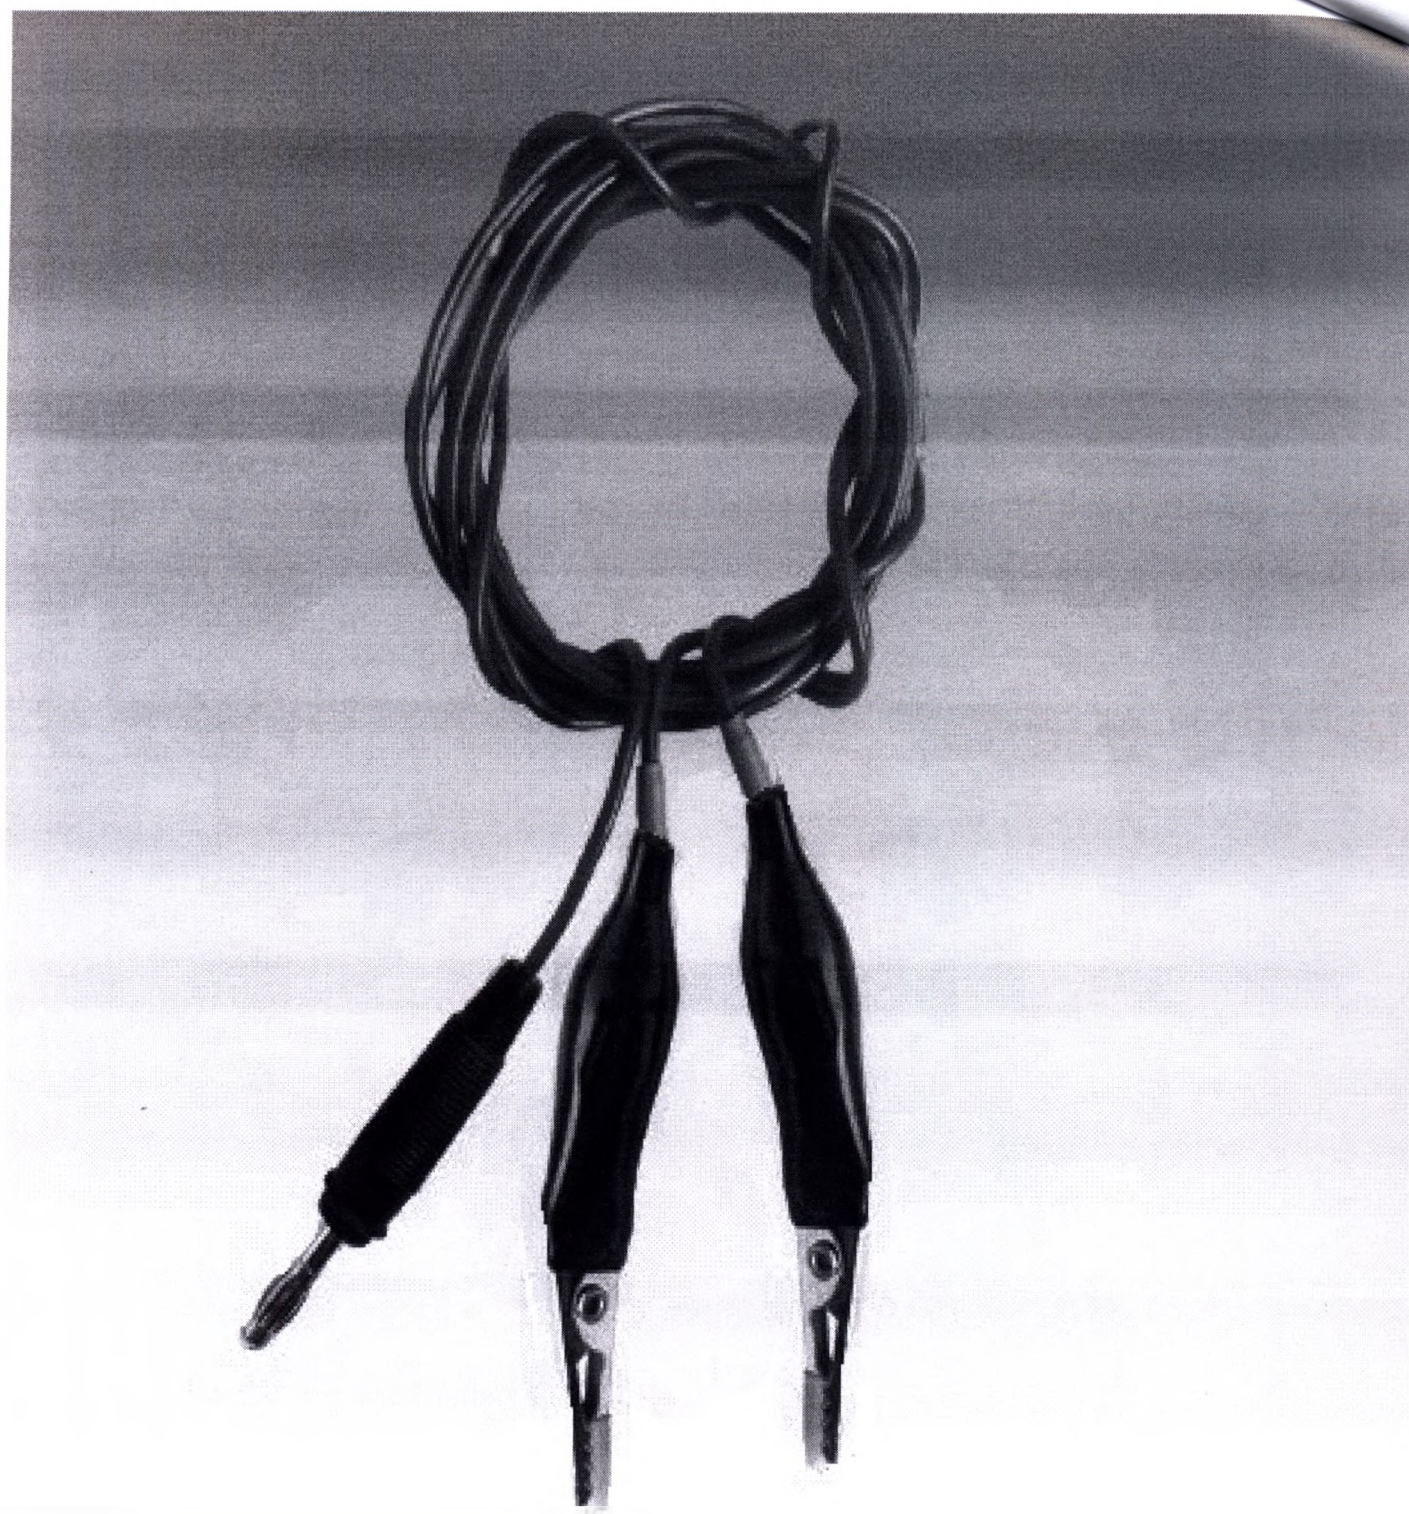






Кабель для присоединения электродов №4



Кабель для присоединения электродов №4

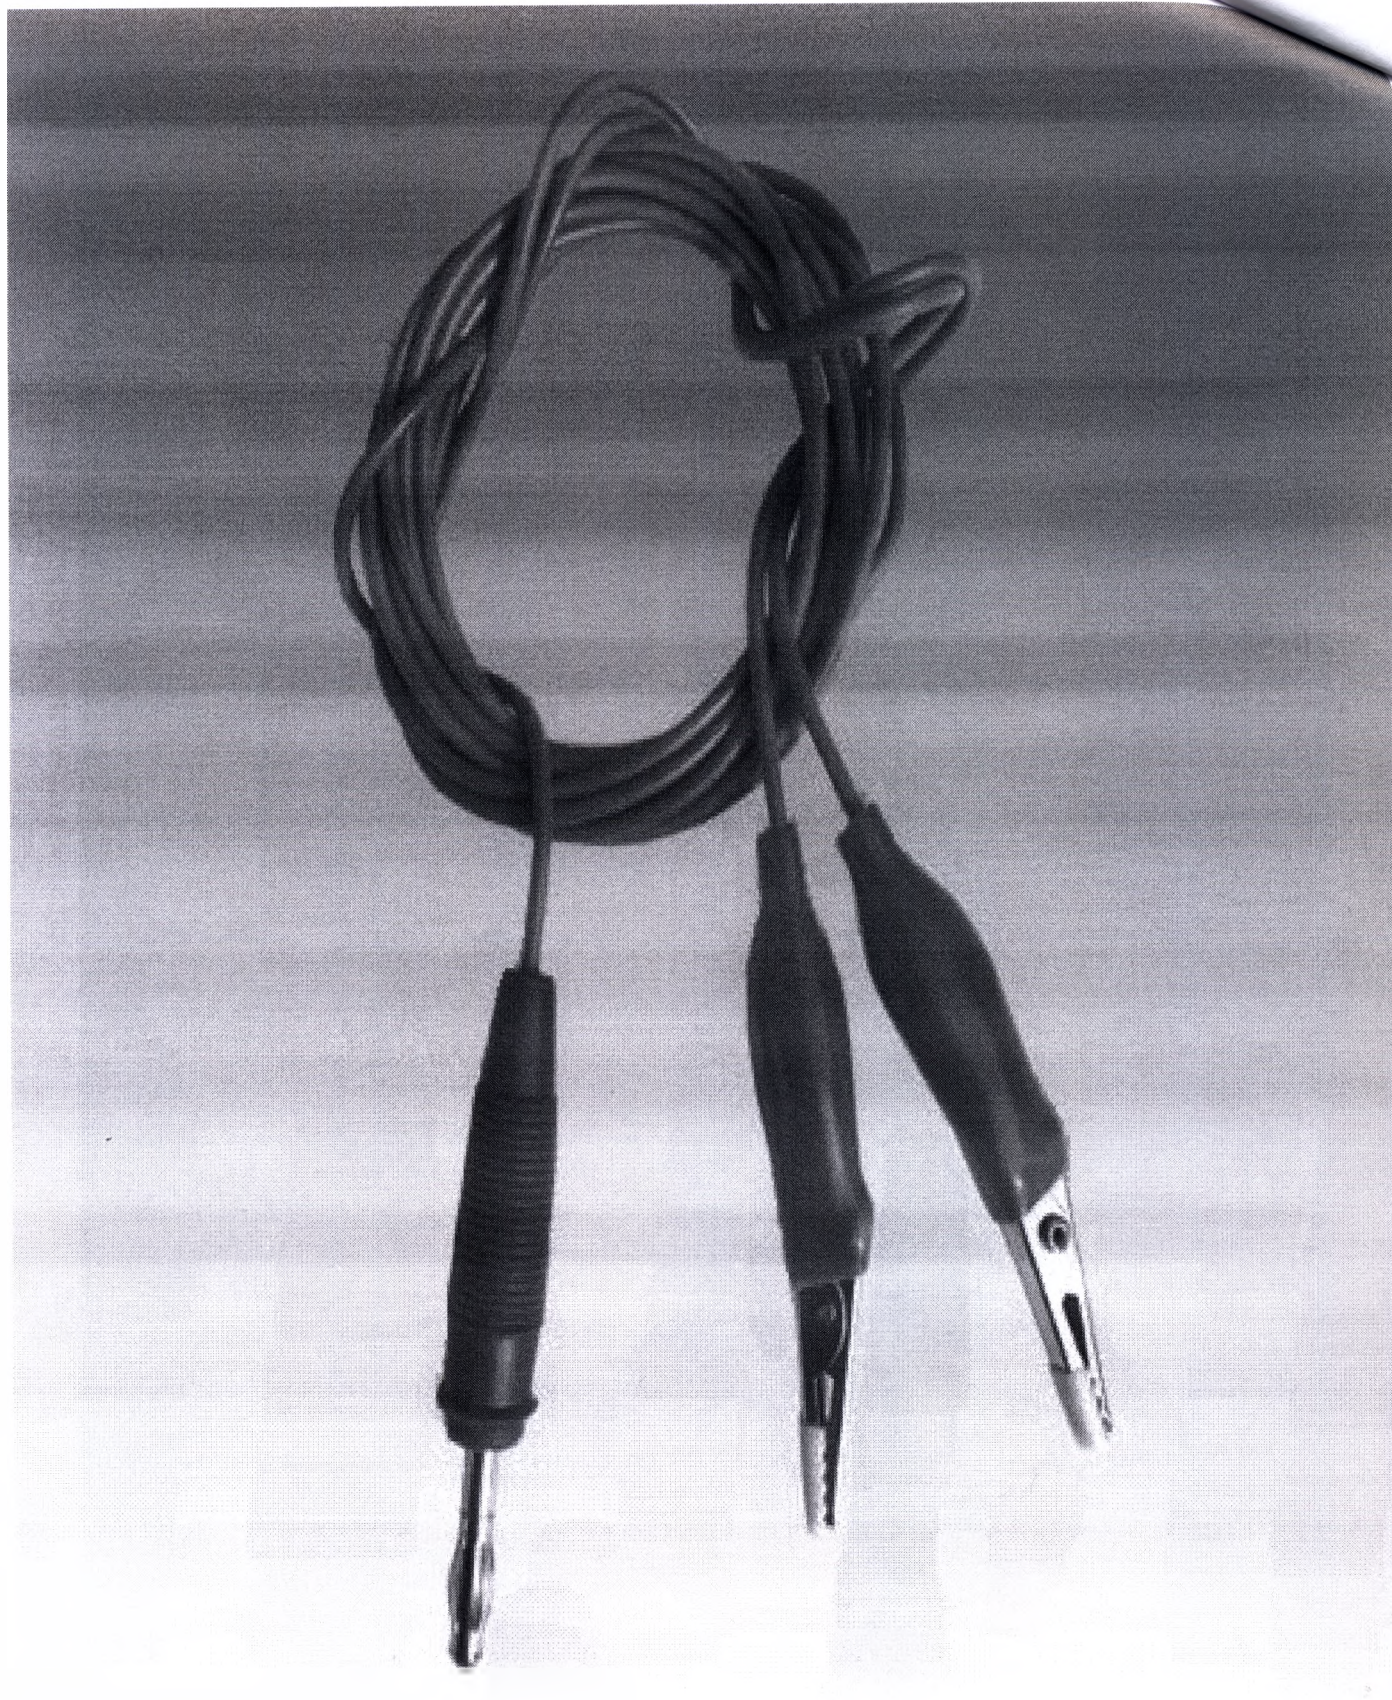

Кабель для присоединения электродов №4

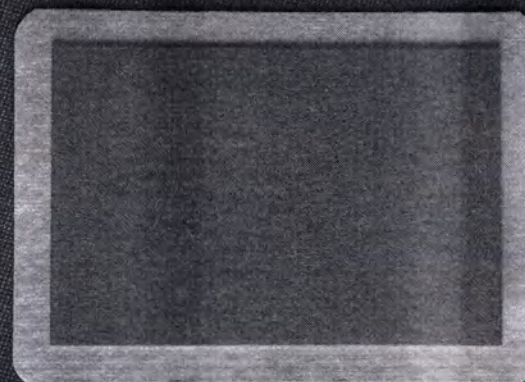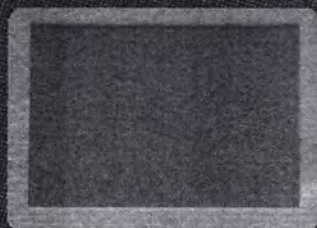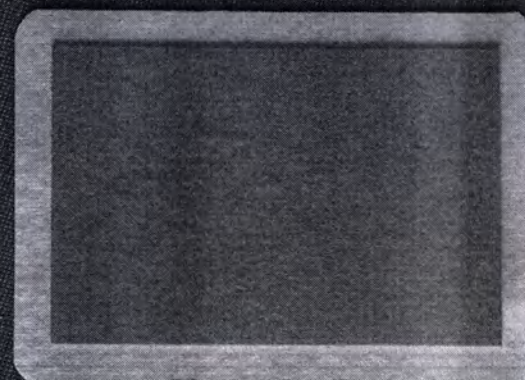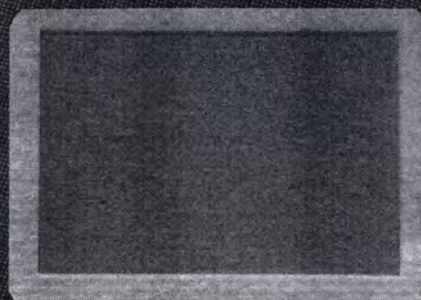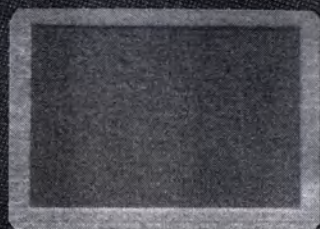

60 x 80

80 x 100

100 x 150

Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур

Директор
ООО «СТД»



А.А. Иванов

Прочито, пронумеровано,
скреплено печатью

____ ЛИСТОВ