

УТВЕРЖДАЮ  
Специалист по регистрации  
ООО «Штрауманн»




М.А. Гребенкина

« 27 » июня 2024 г.


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

«Сверло стоматологическое для установки имплантата ANTHOGRYR в вариантах исполнения с принадлежностями»


Сверло 2.8, диаметр 2.0 мм

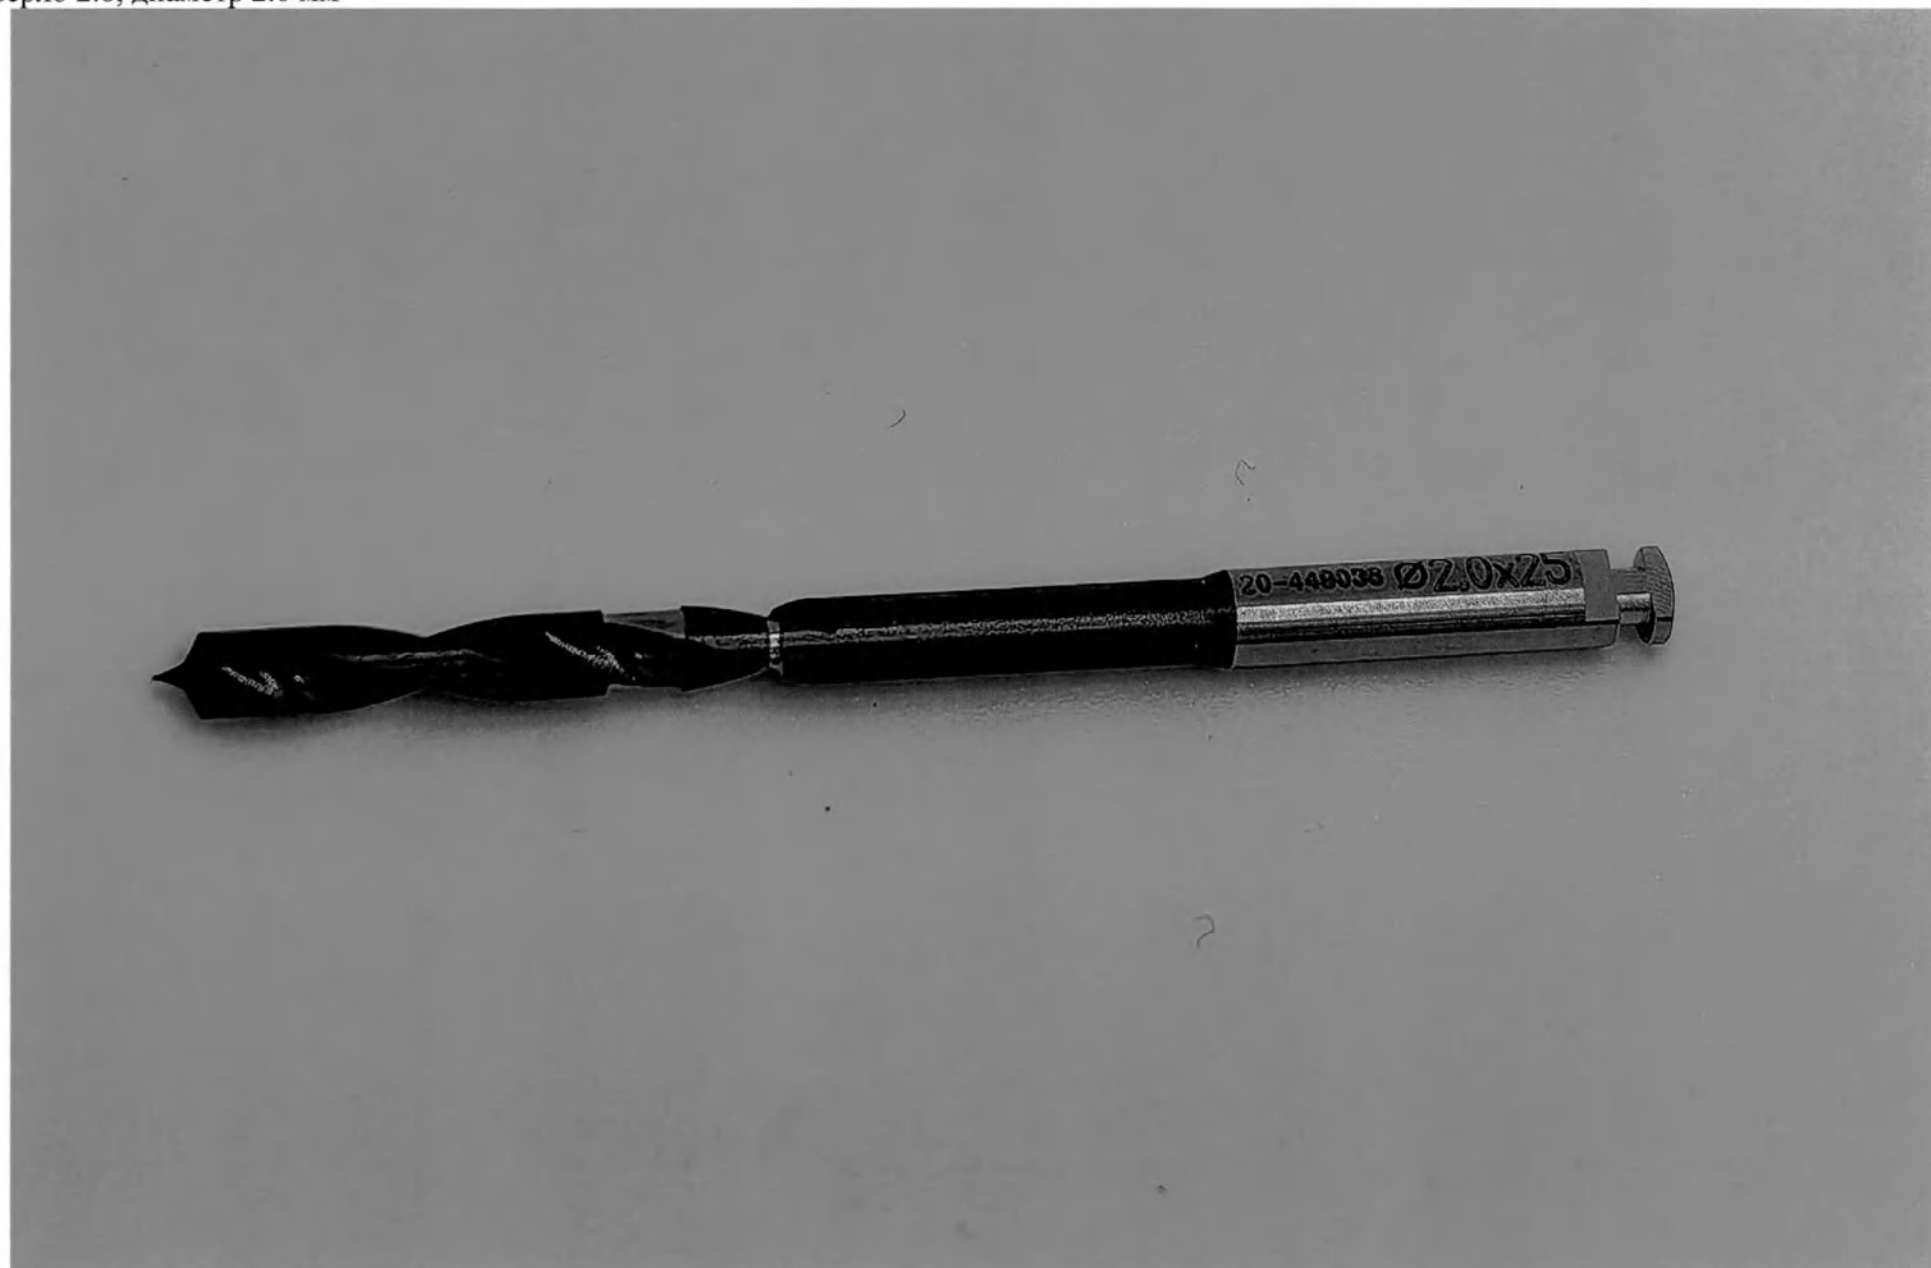

Сверло 2.8, диаметр 2.6 мм

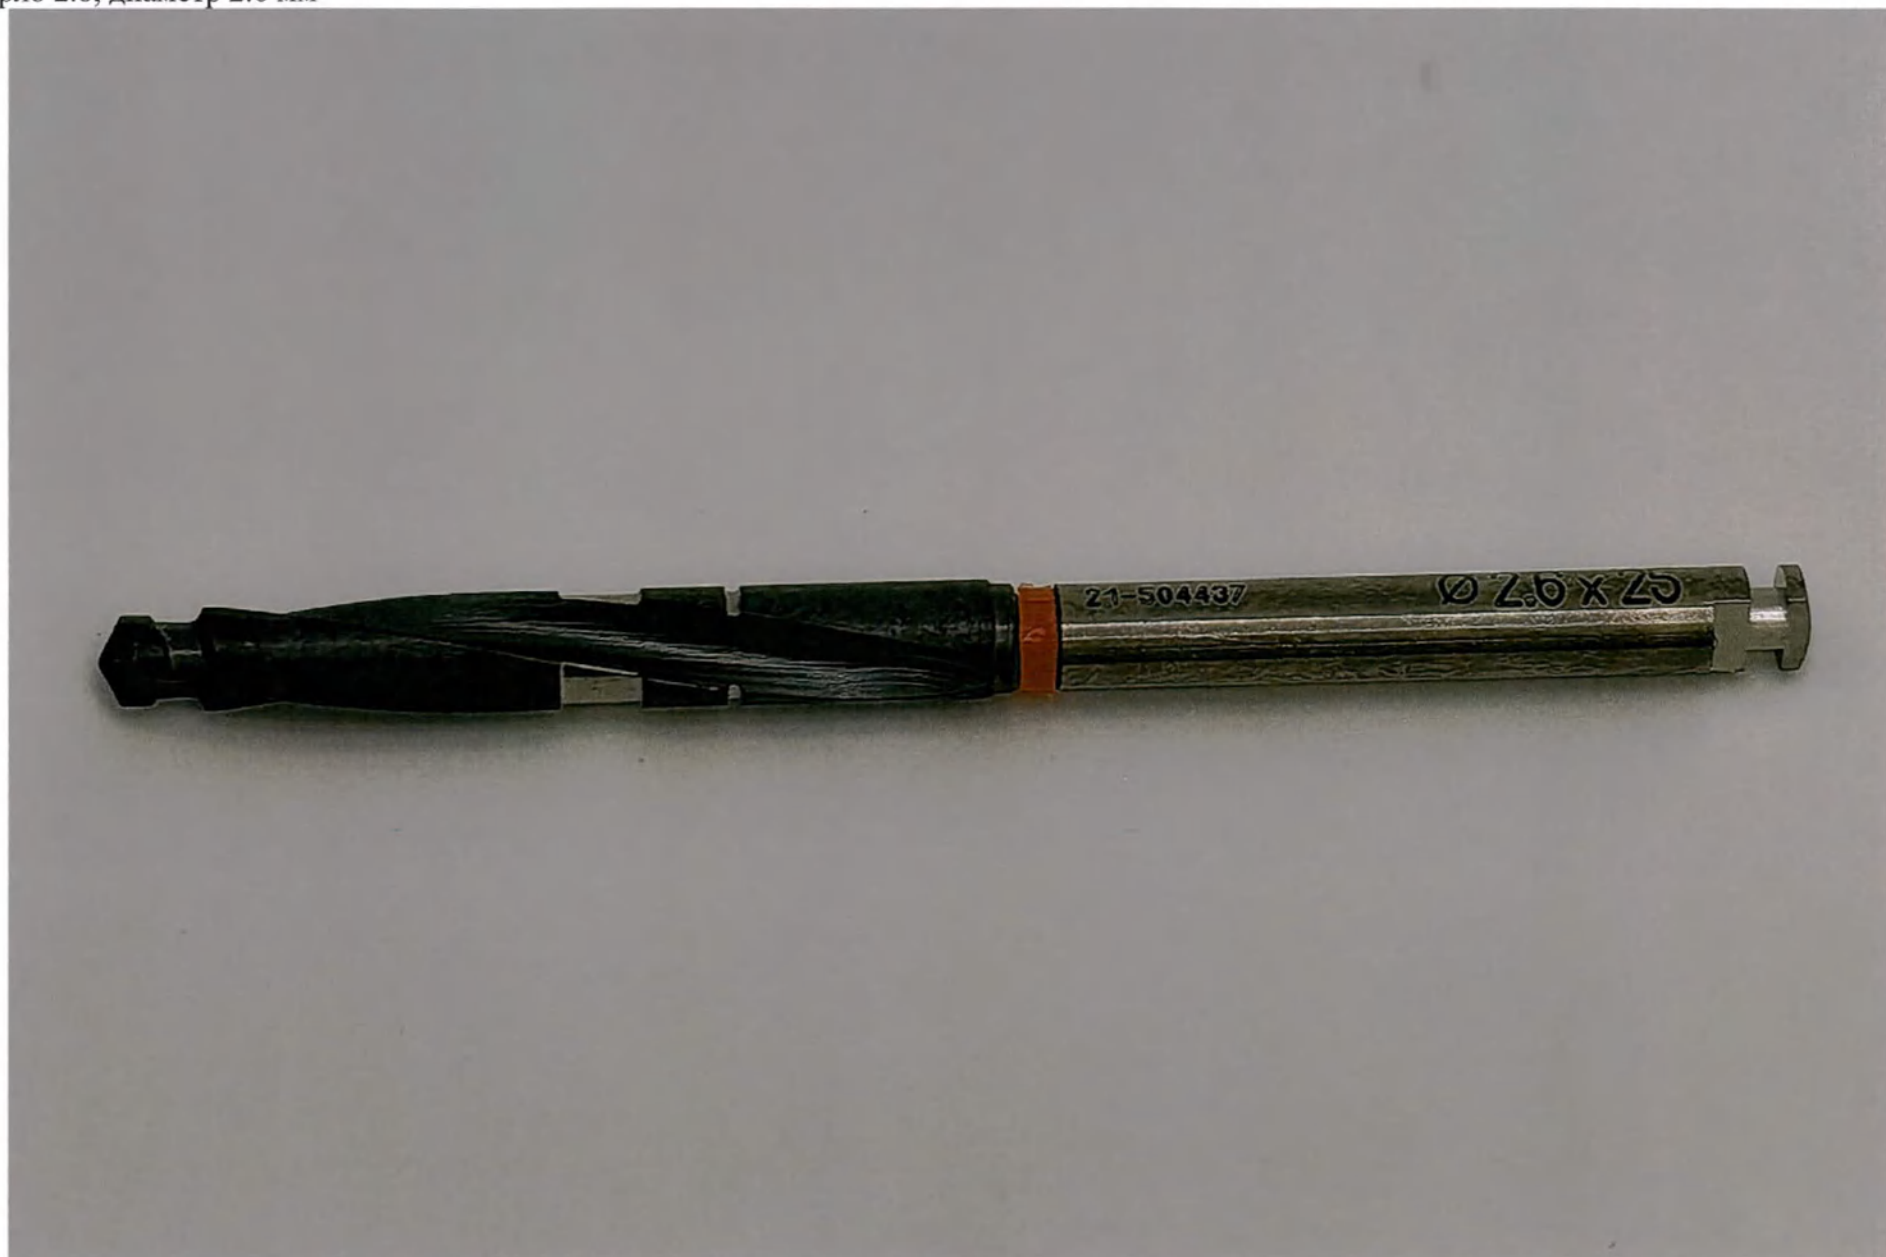


Сверло Lindemann, диаметр 2.0 мм

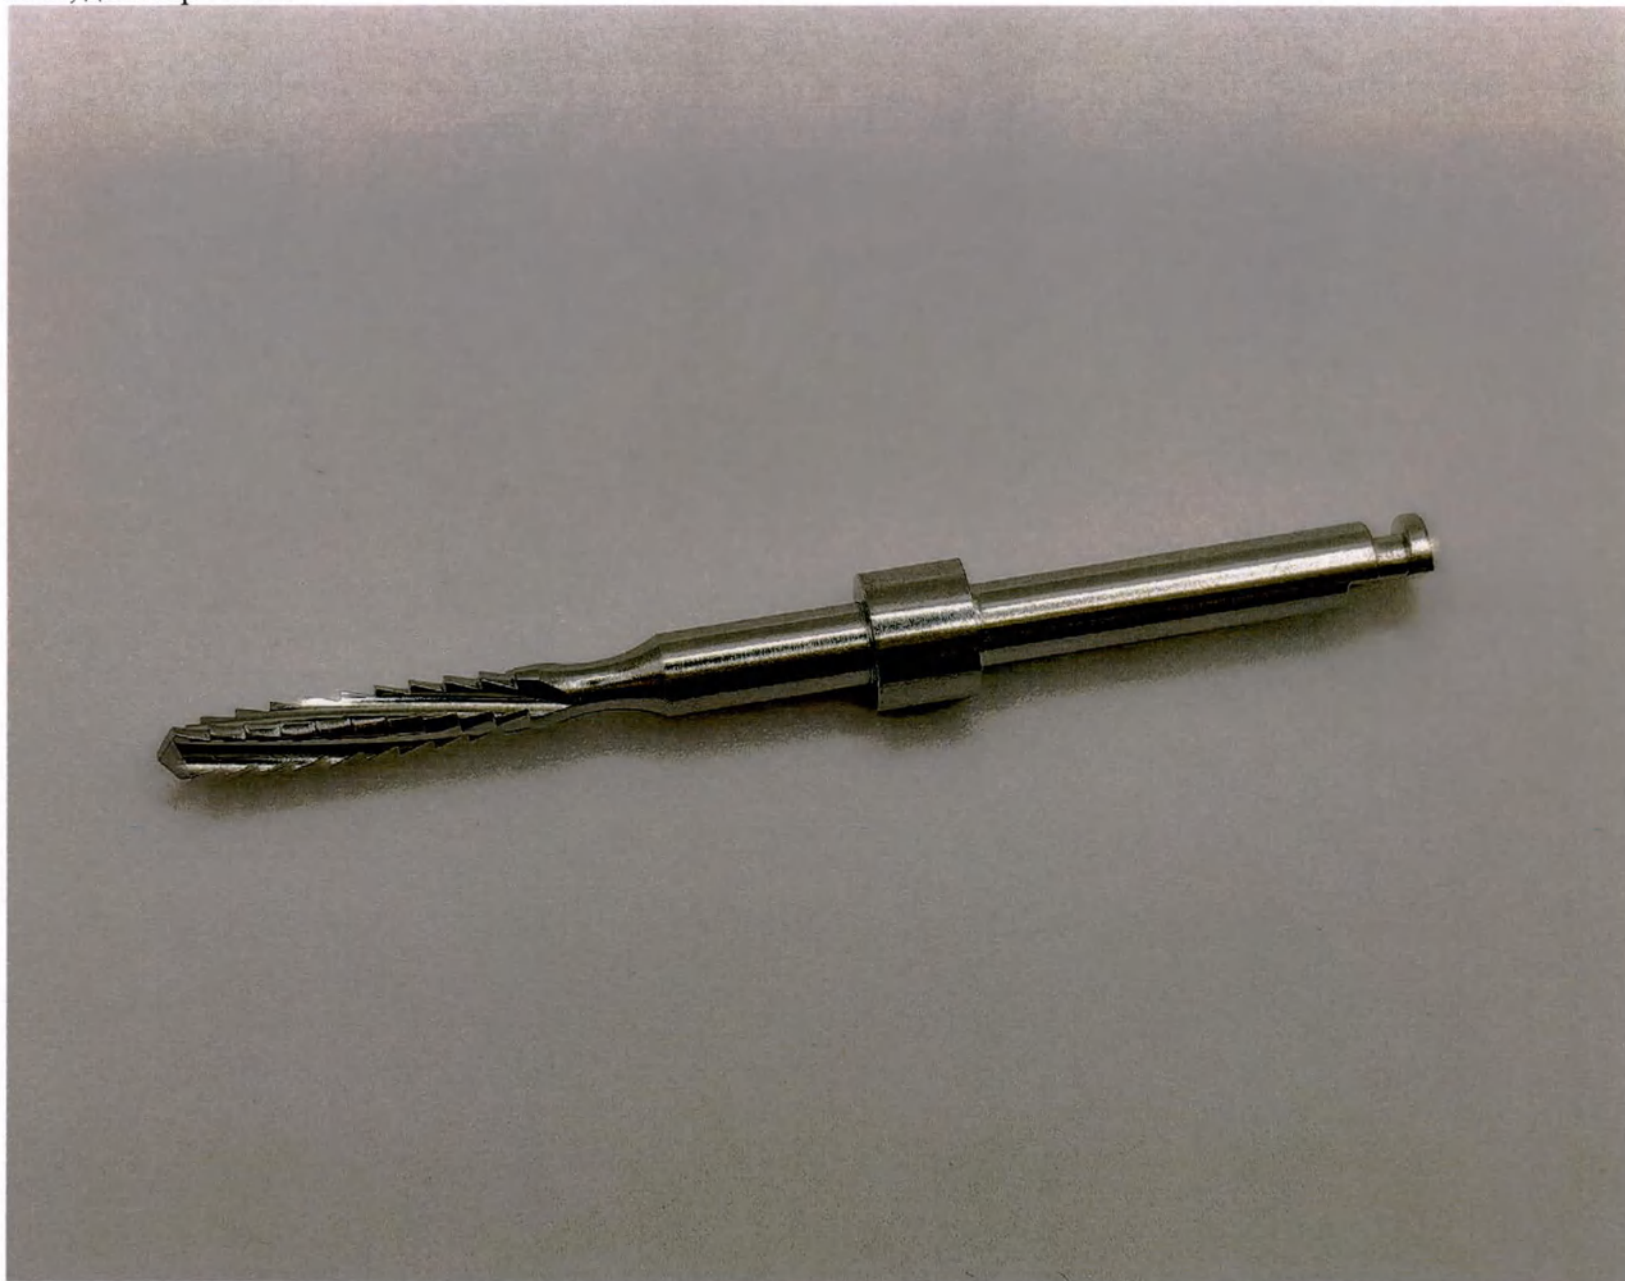


Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм

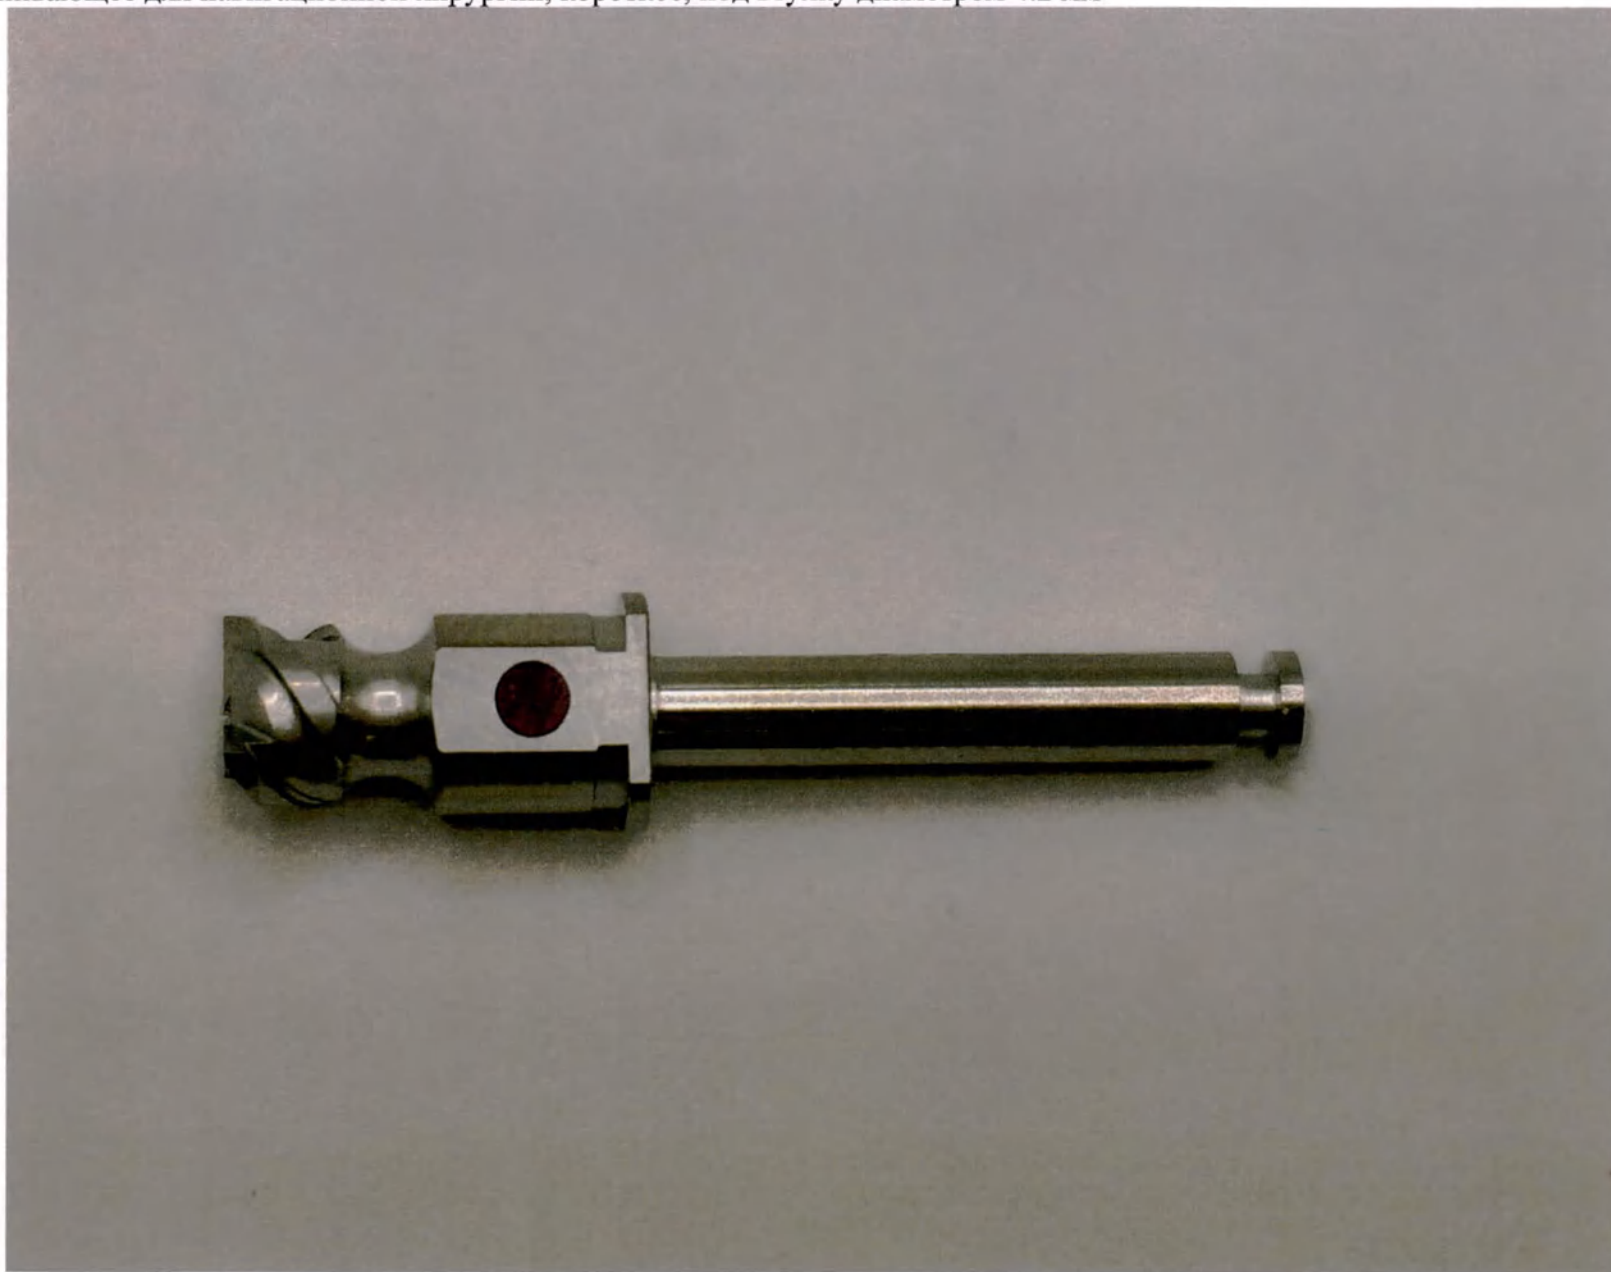

Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм

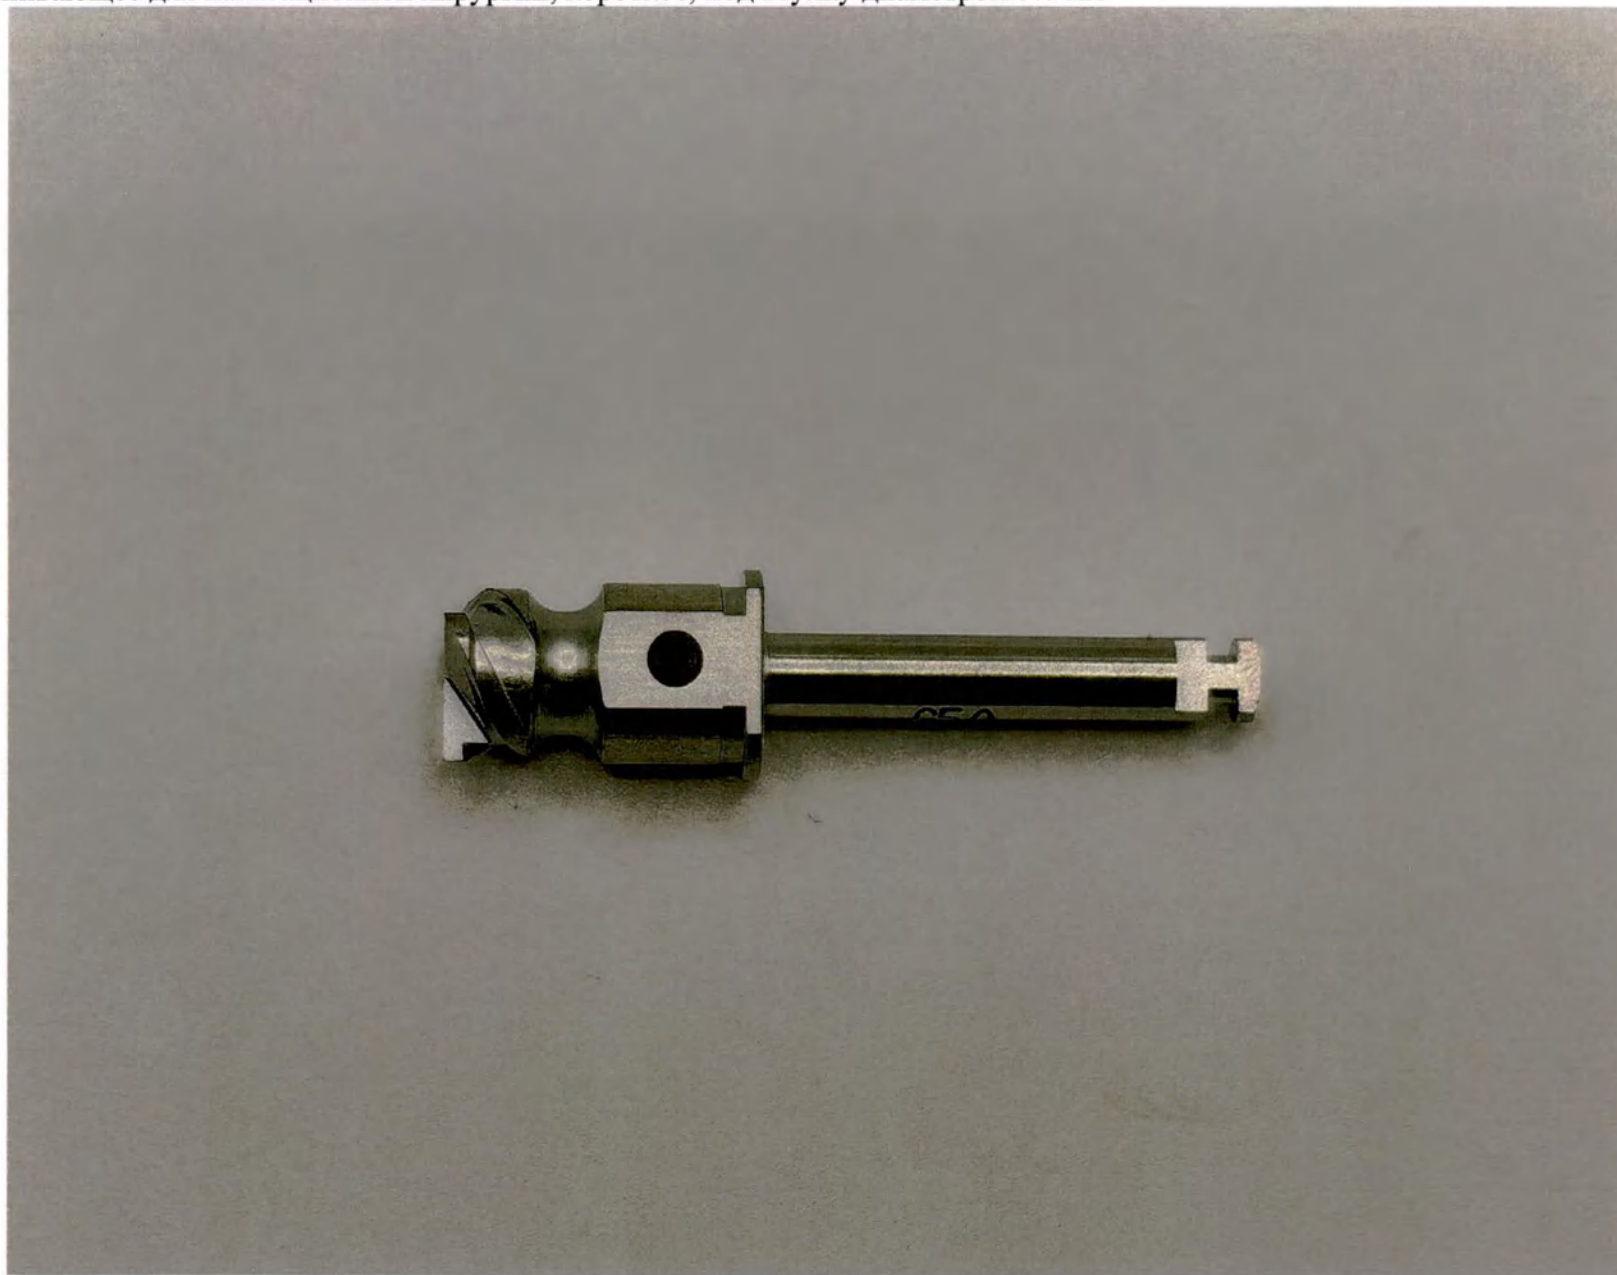

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

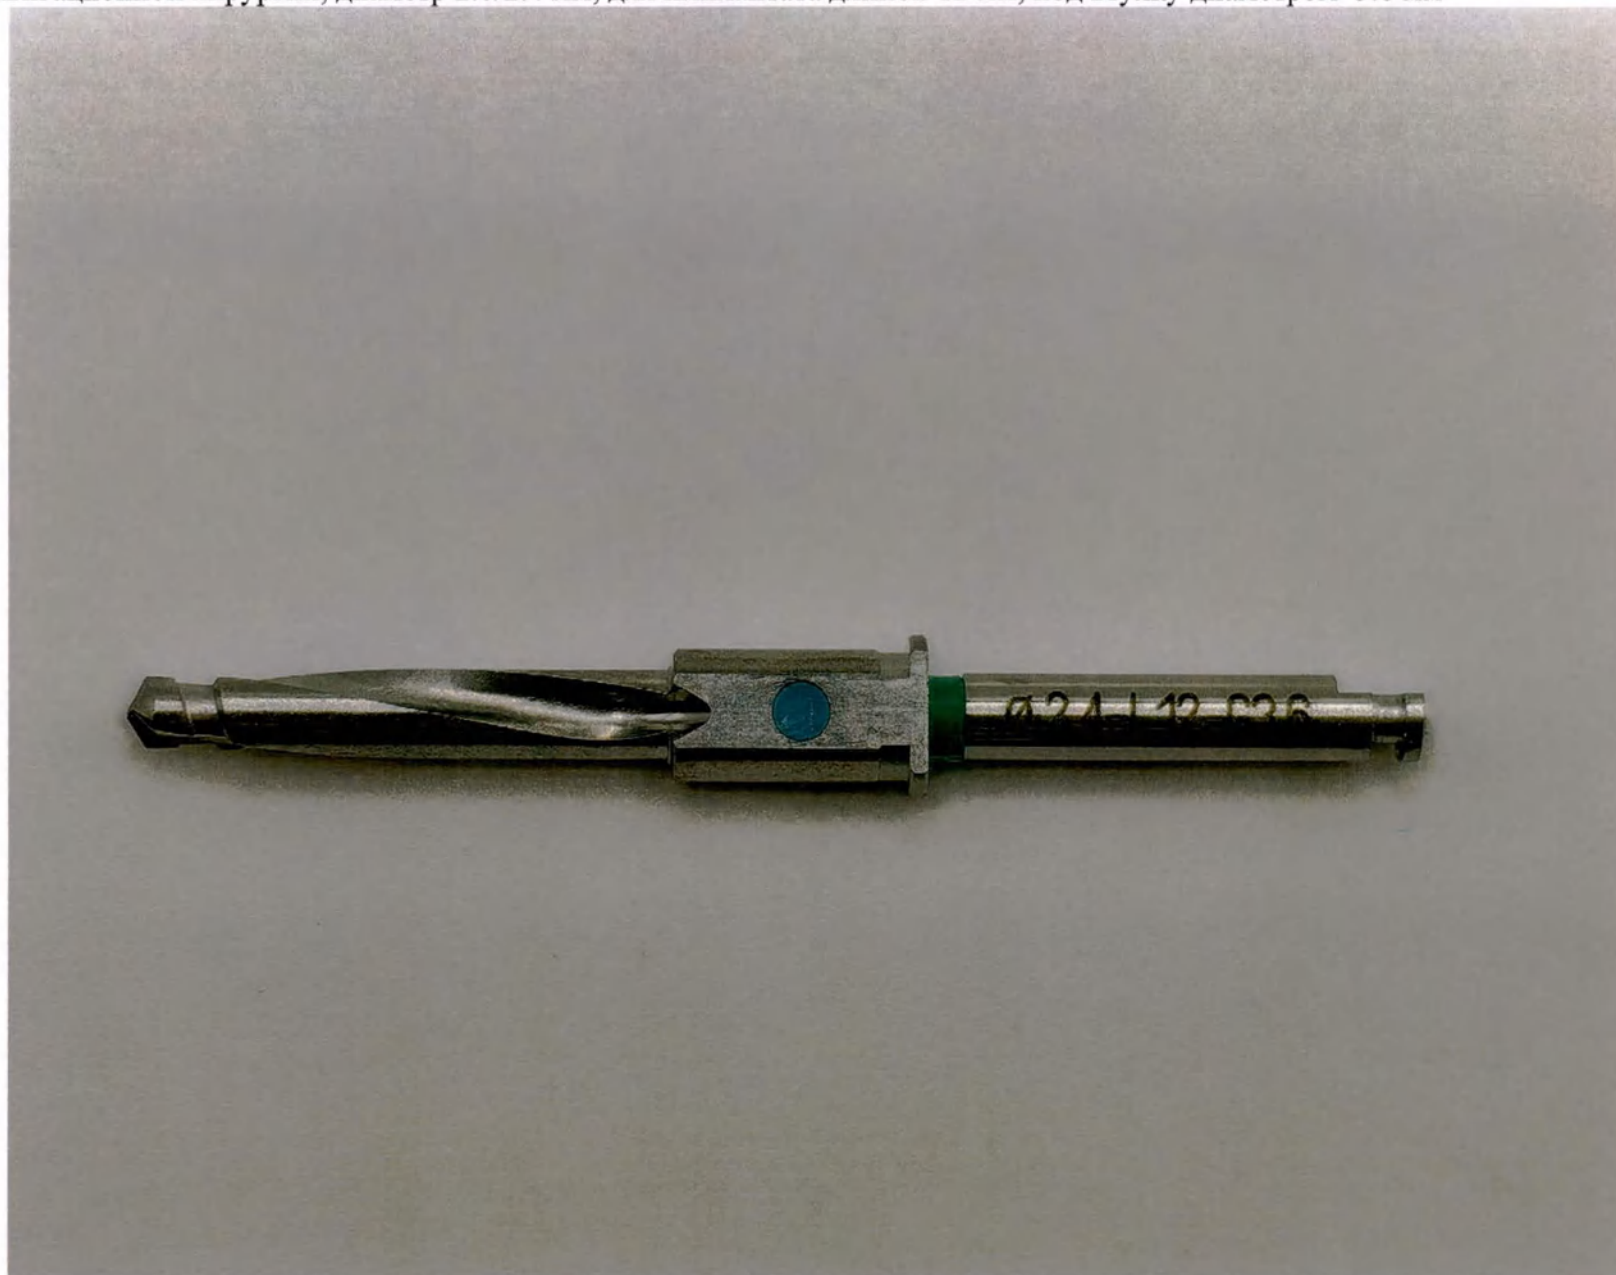

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

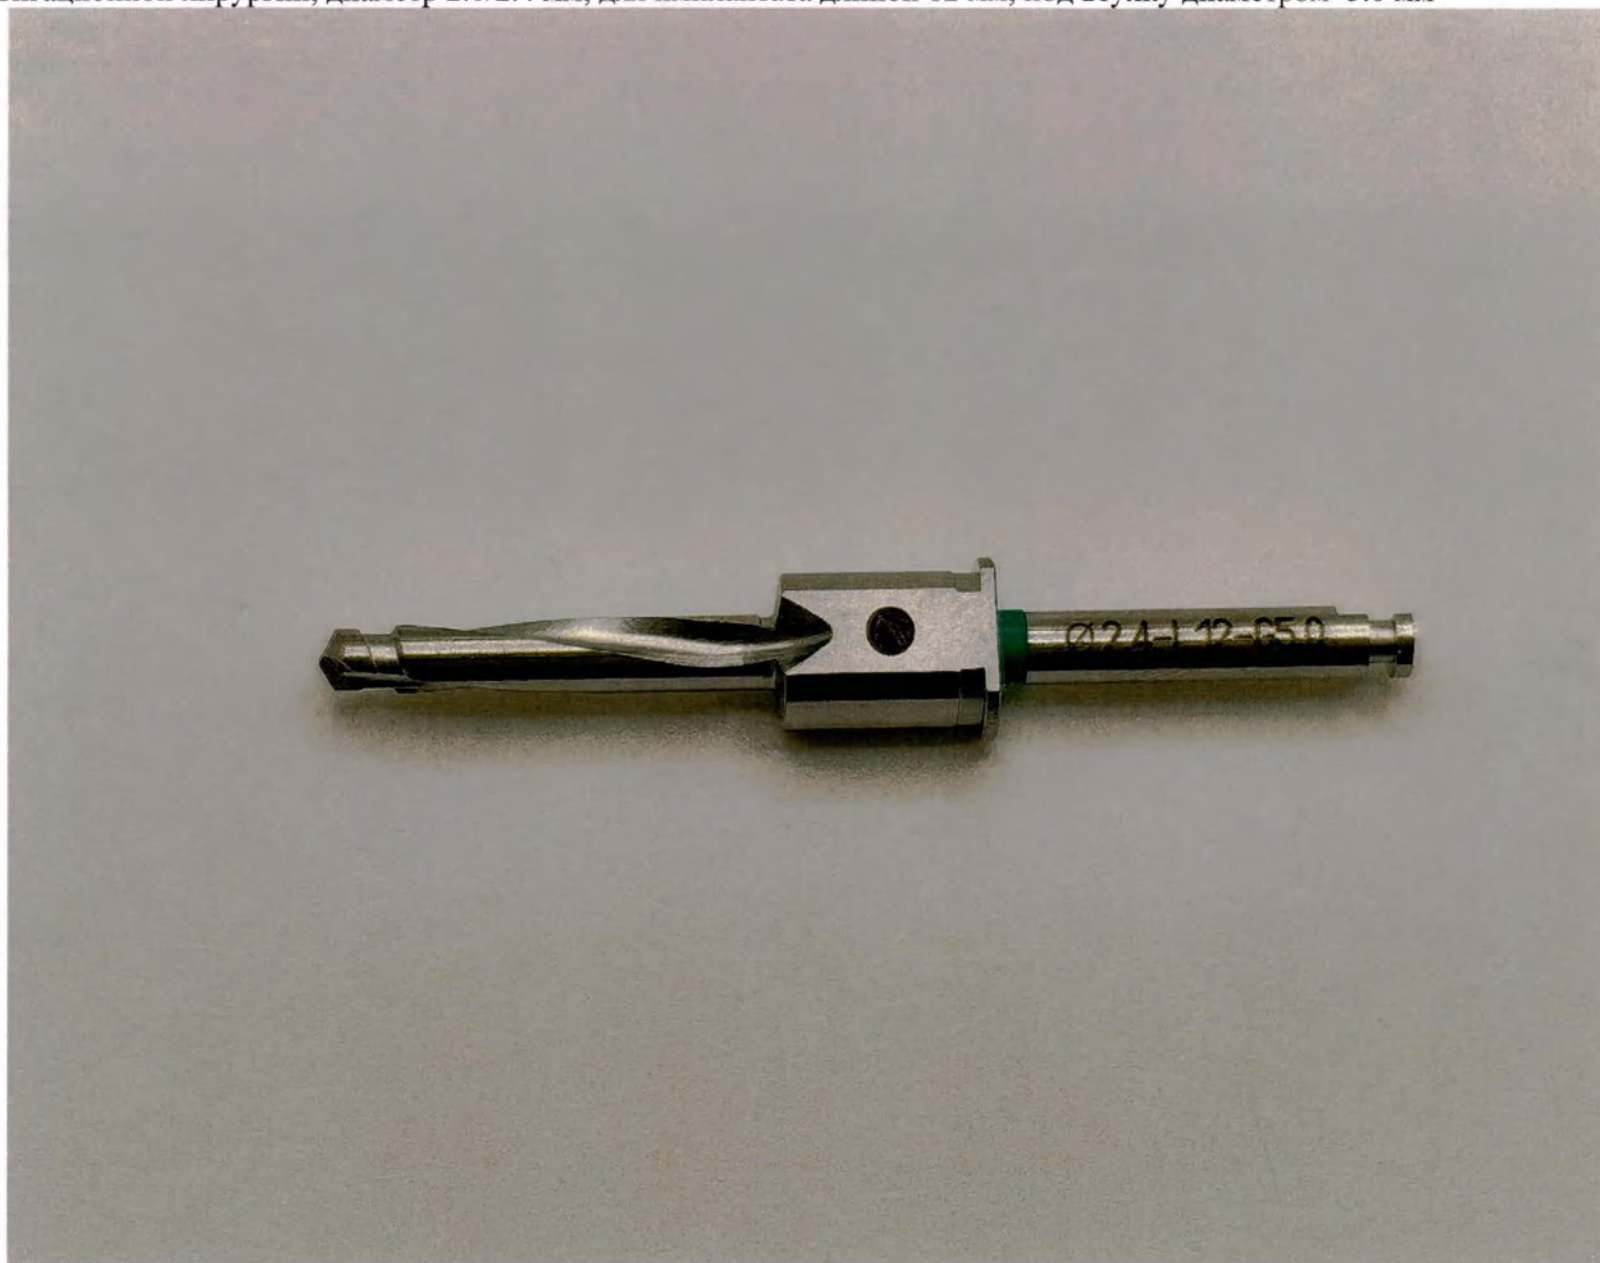

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

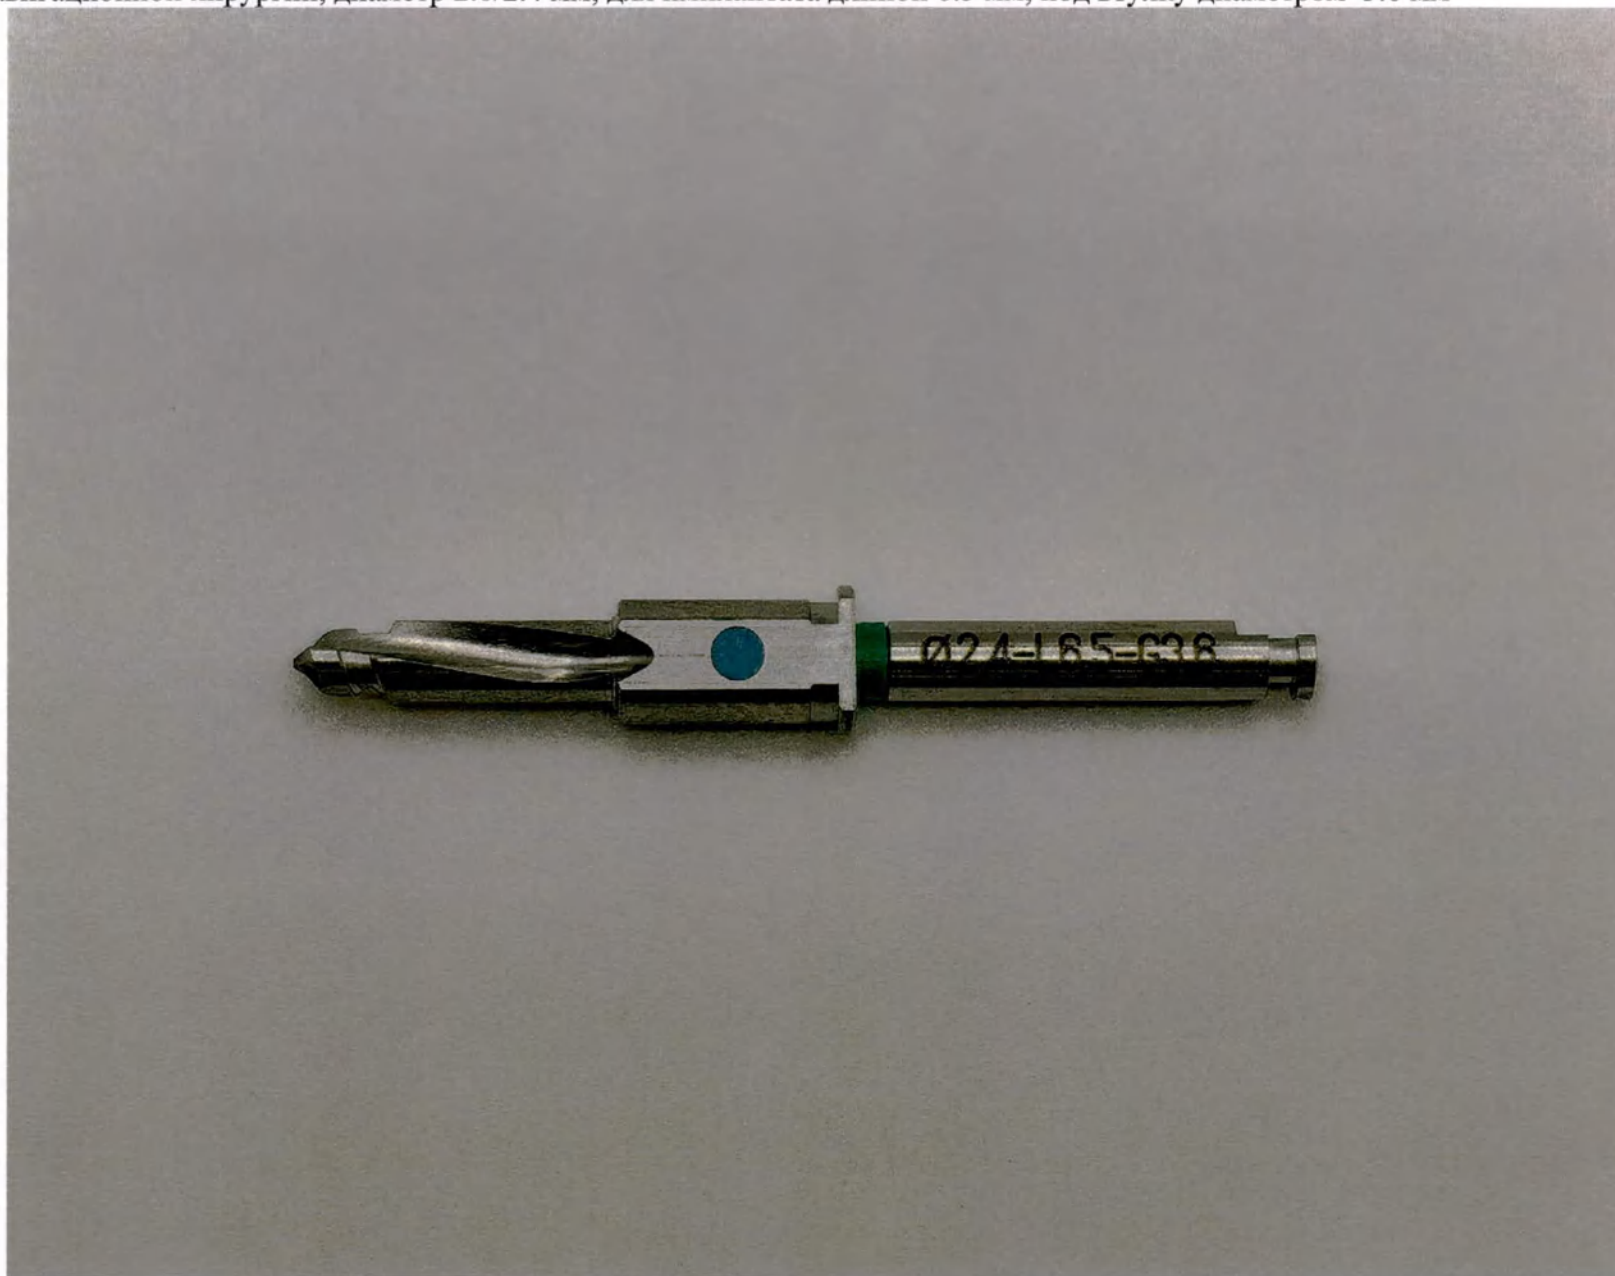


Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

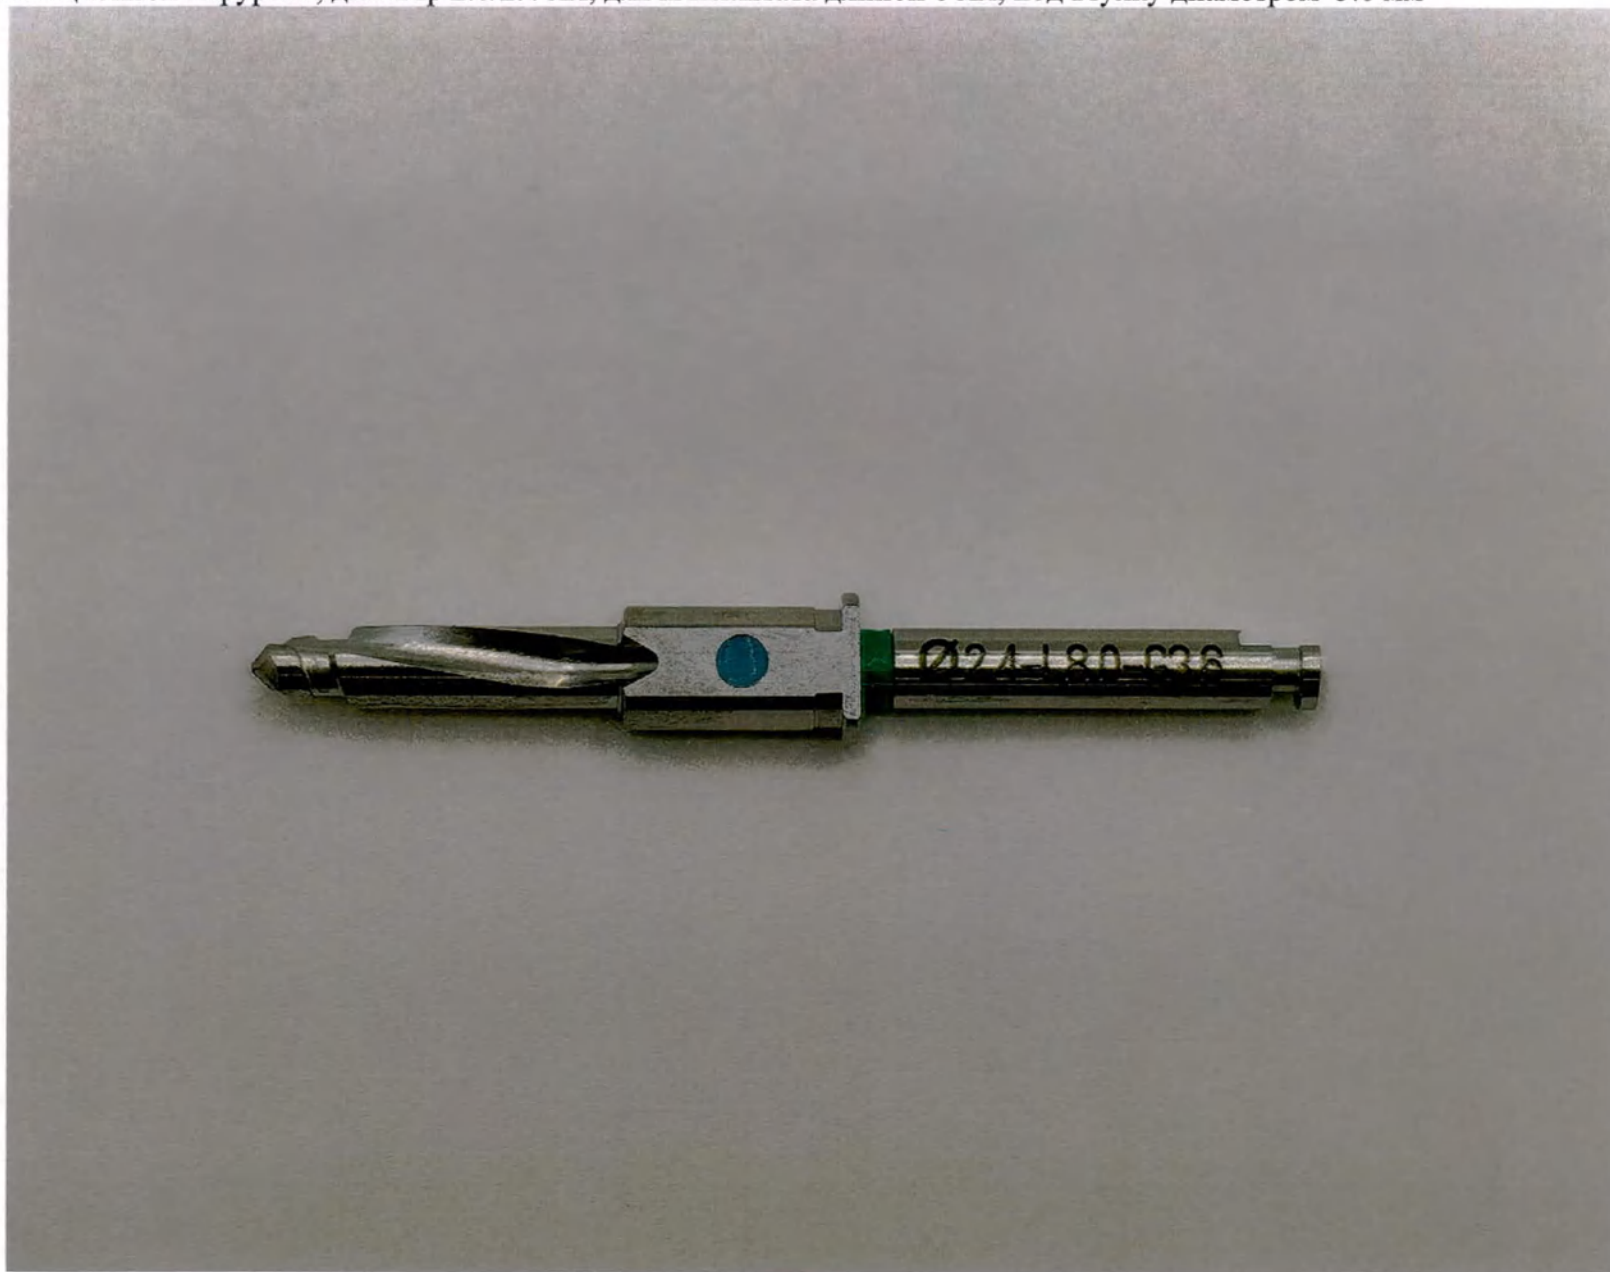


Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм

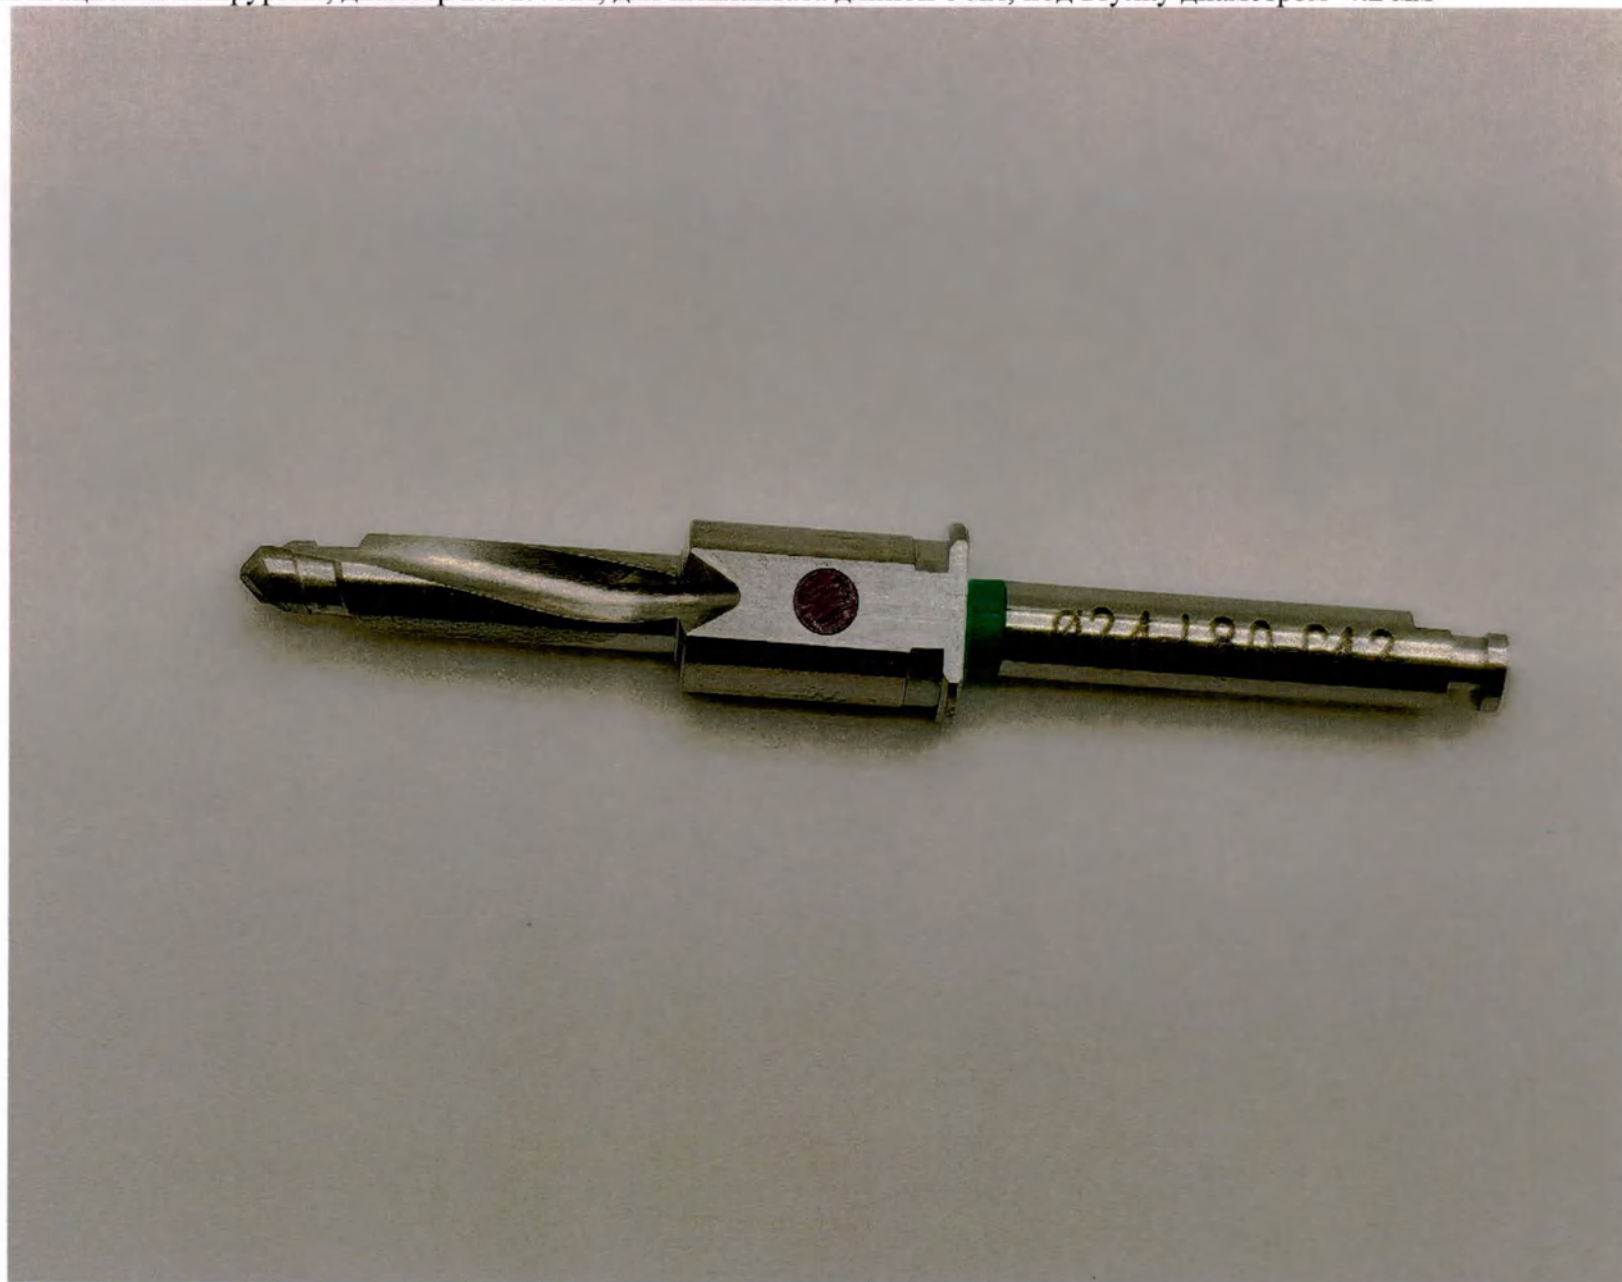

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

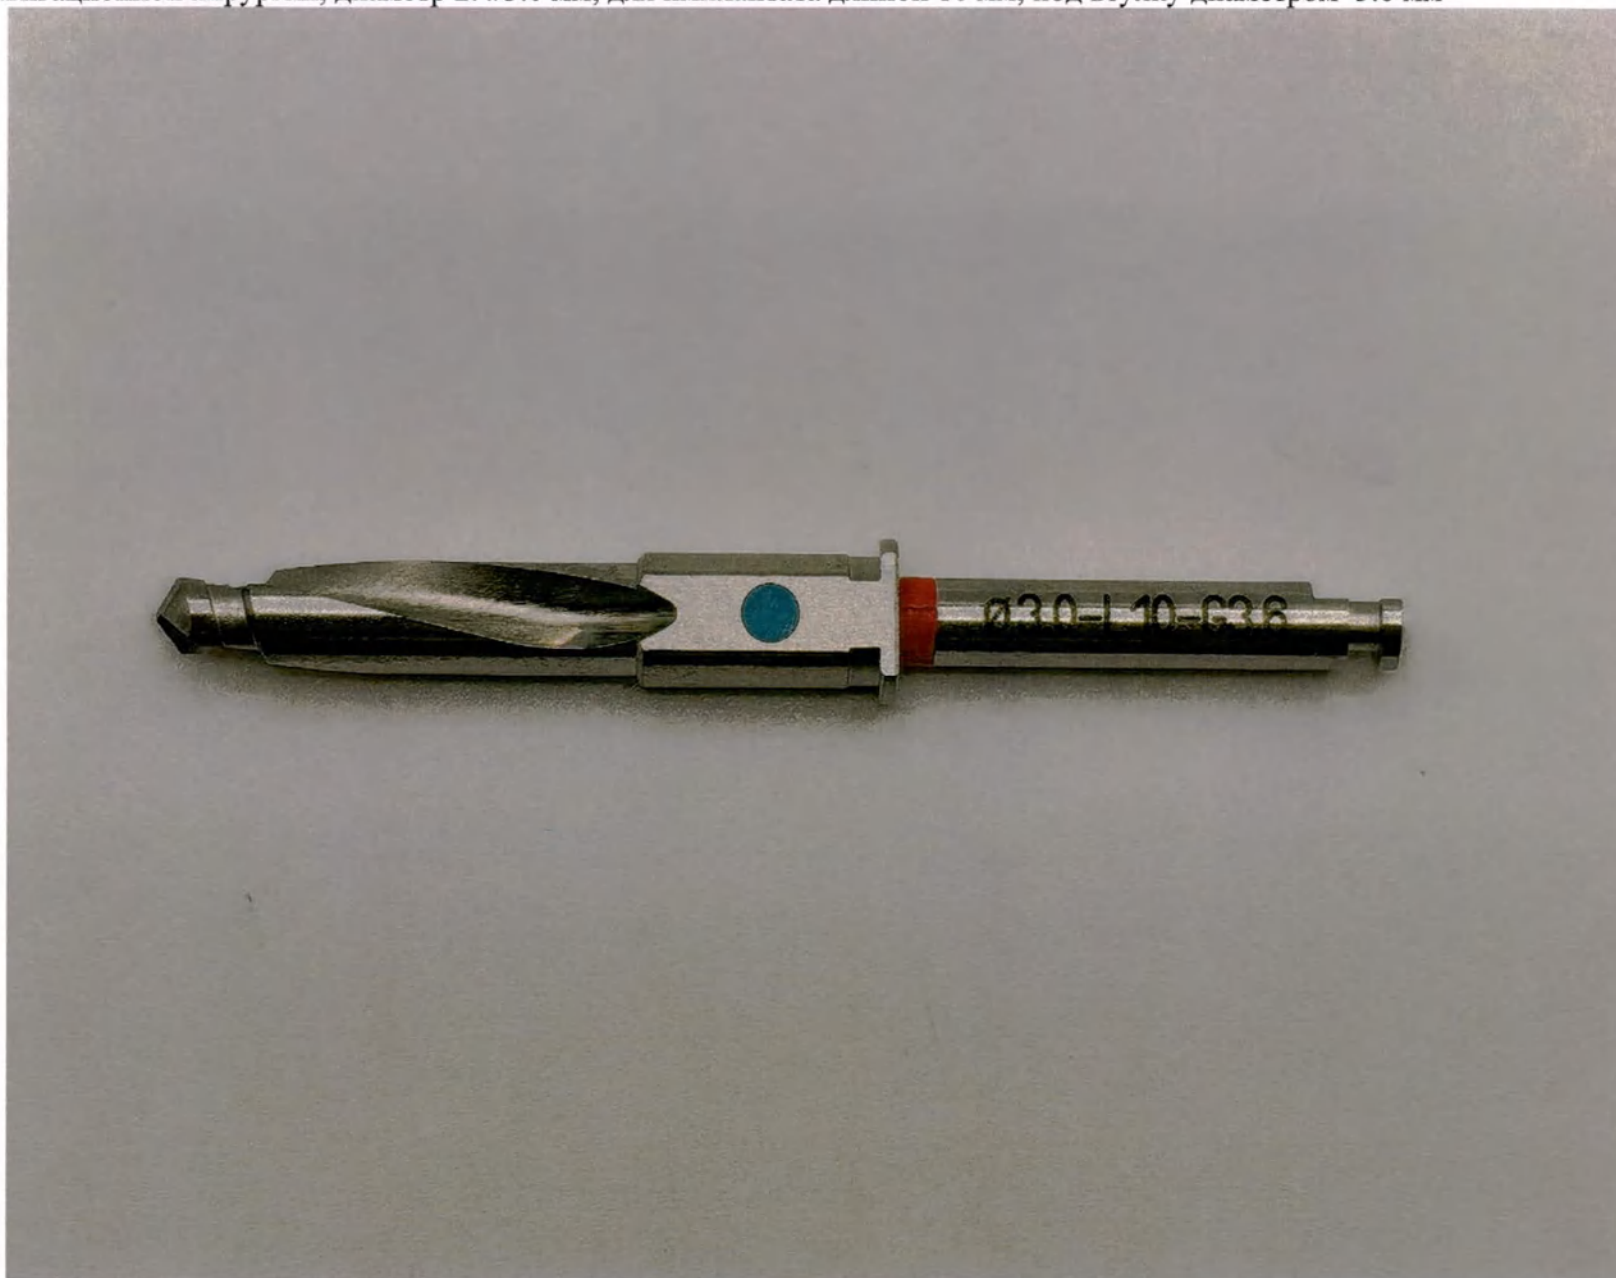

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

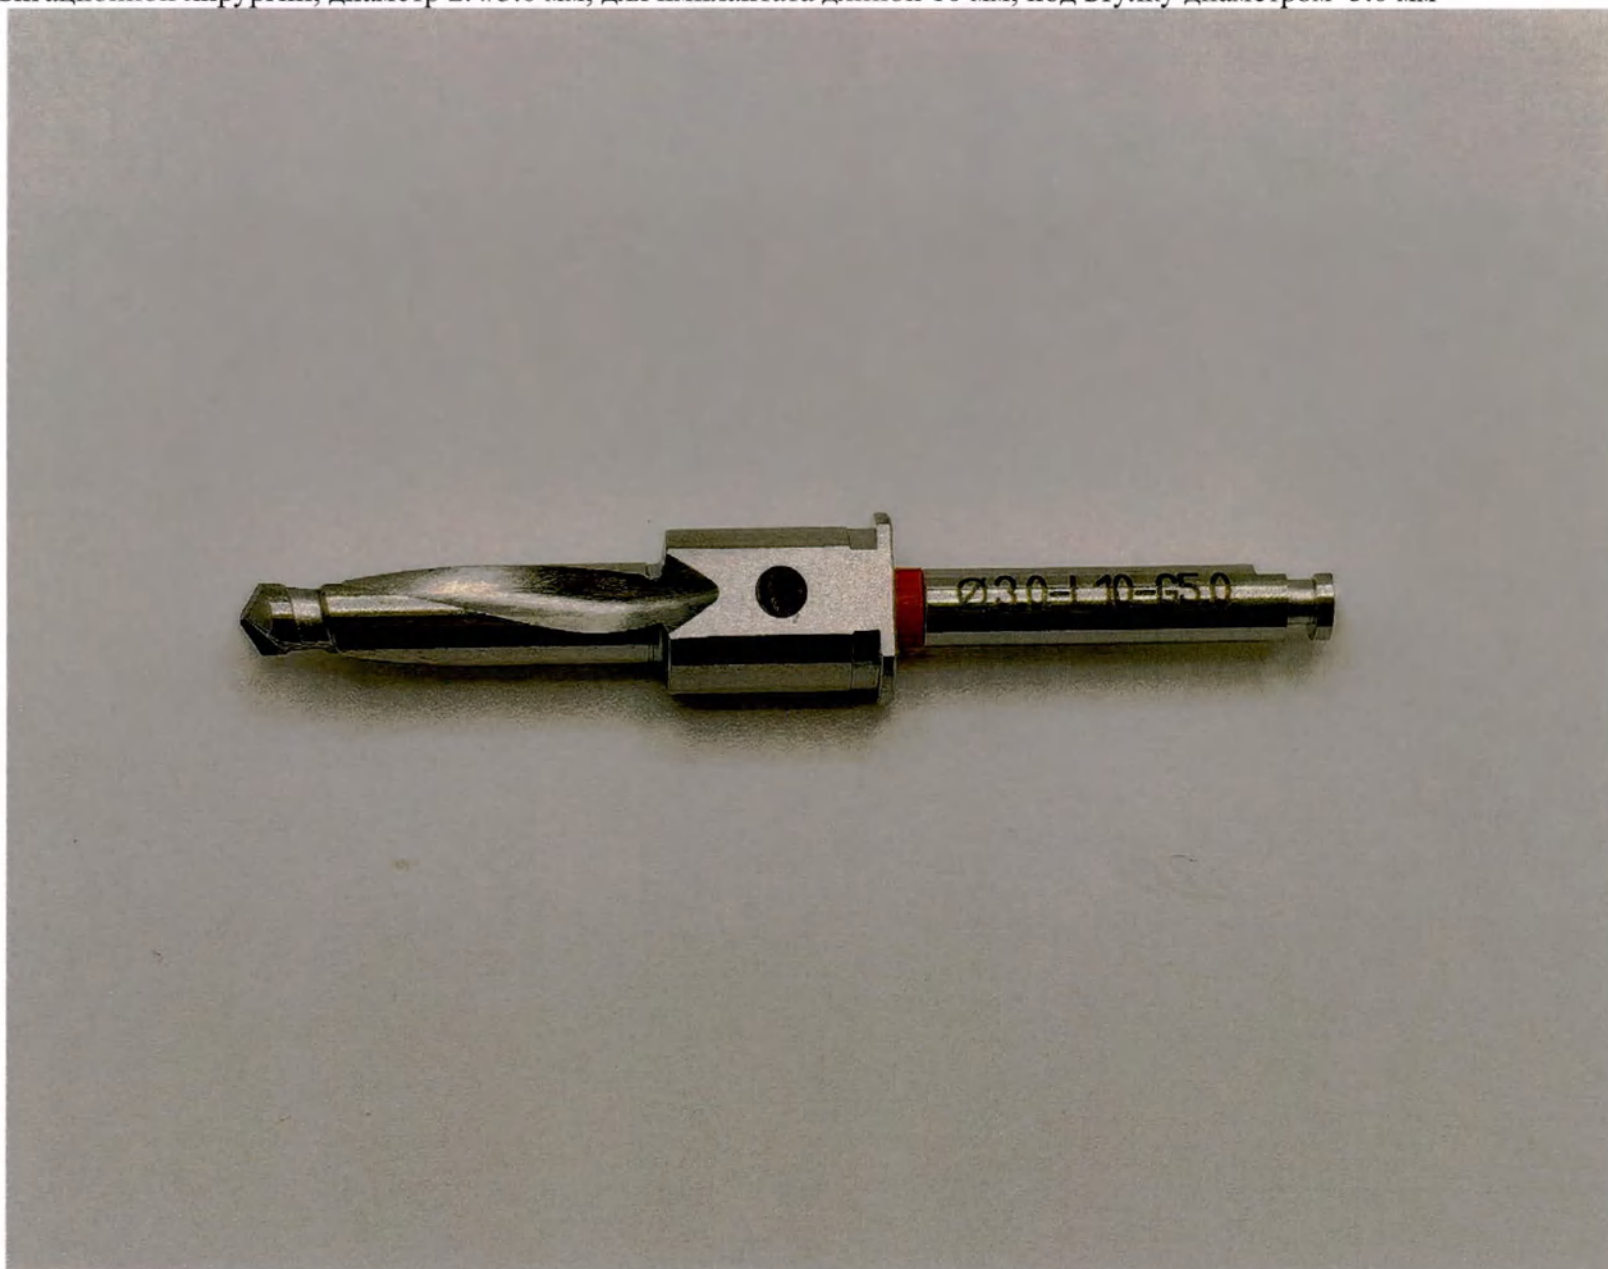

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

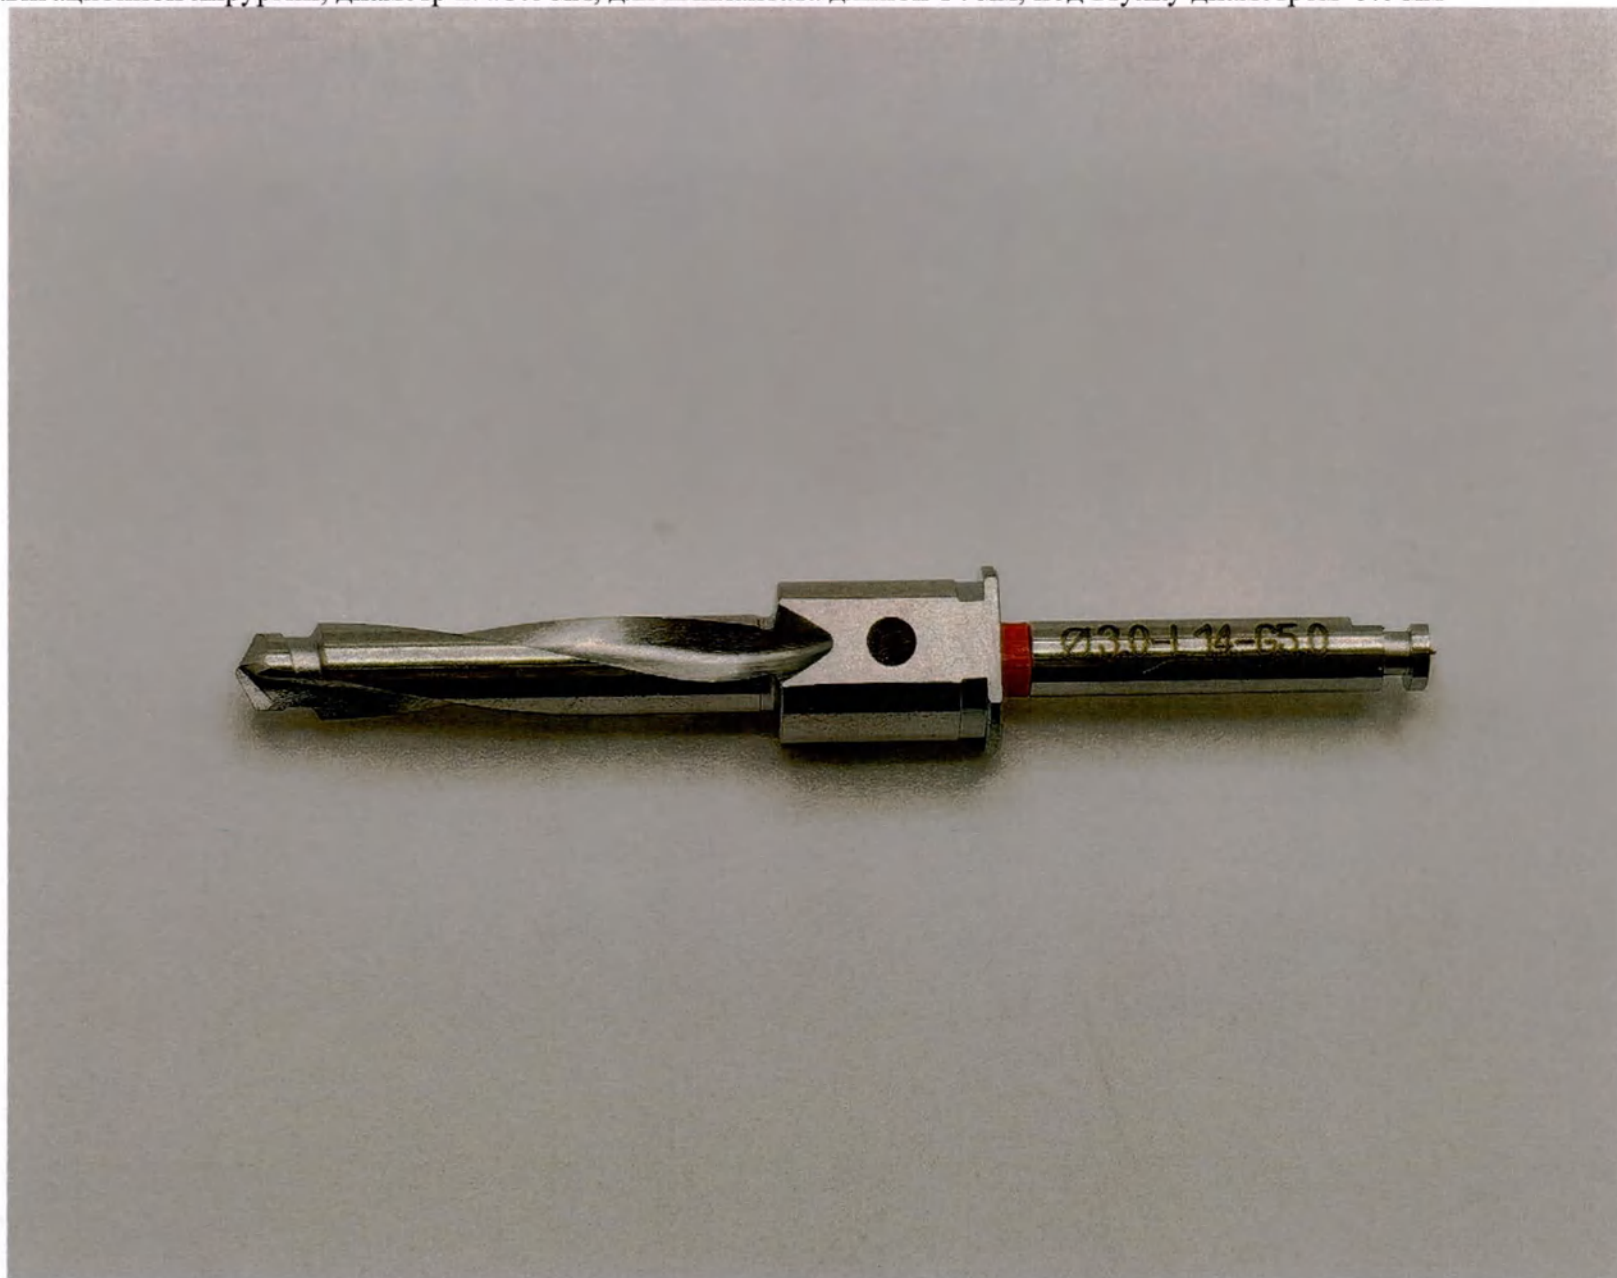


Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

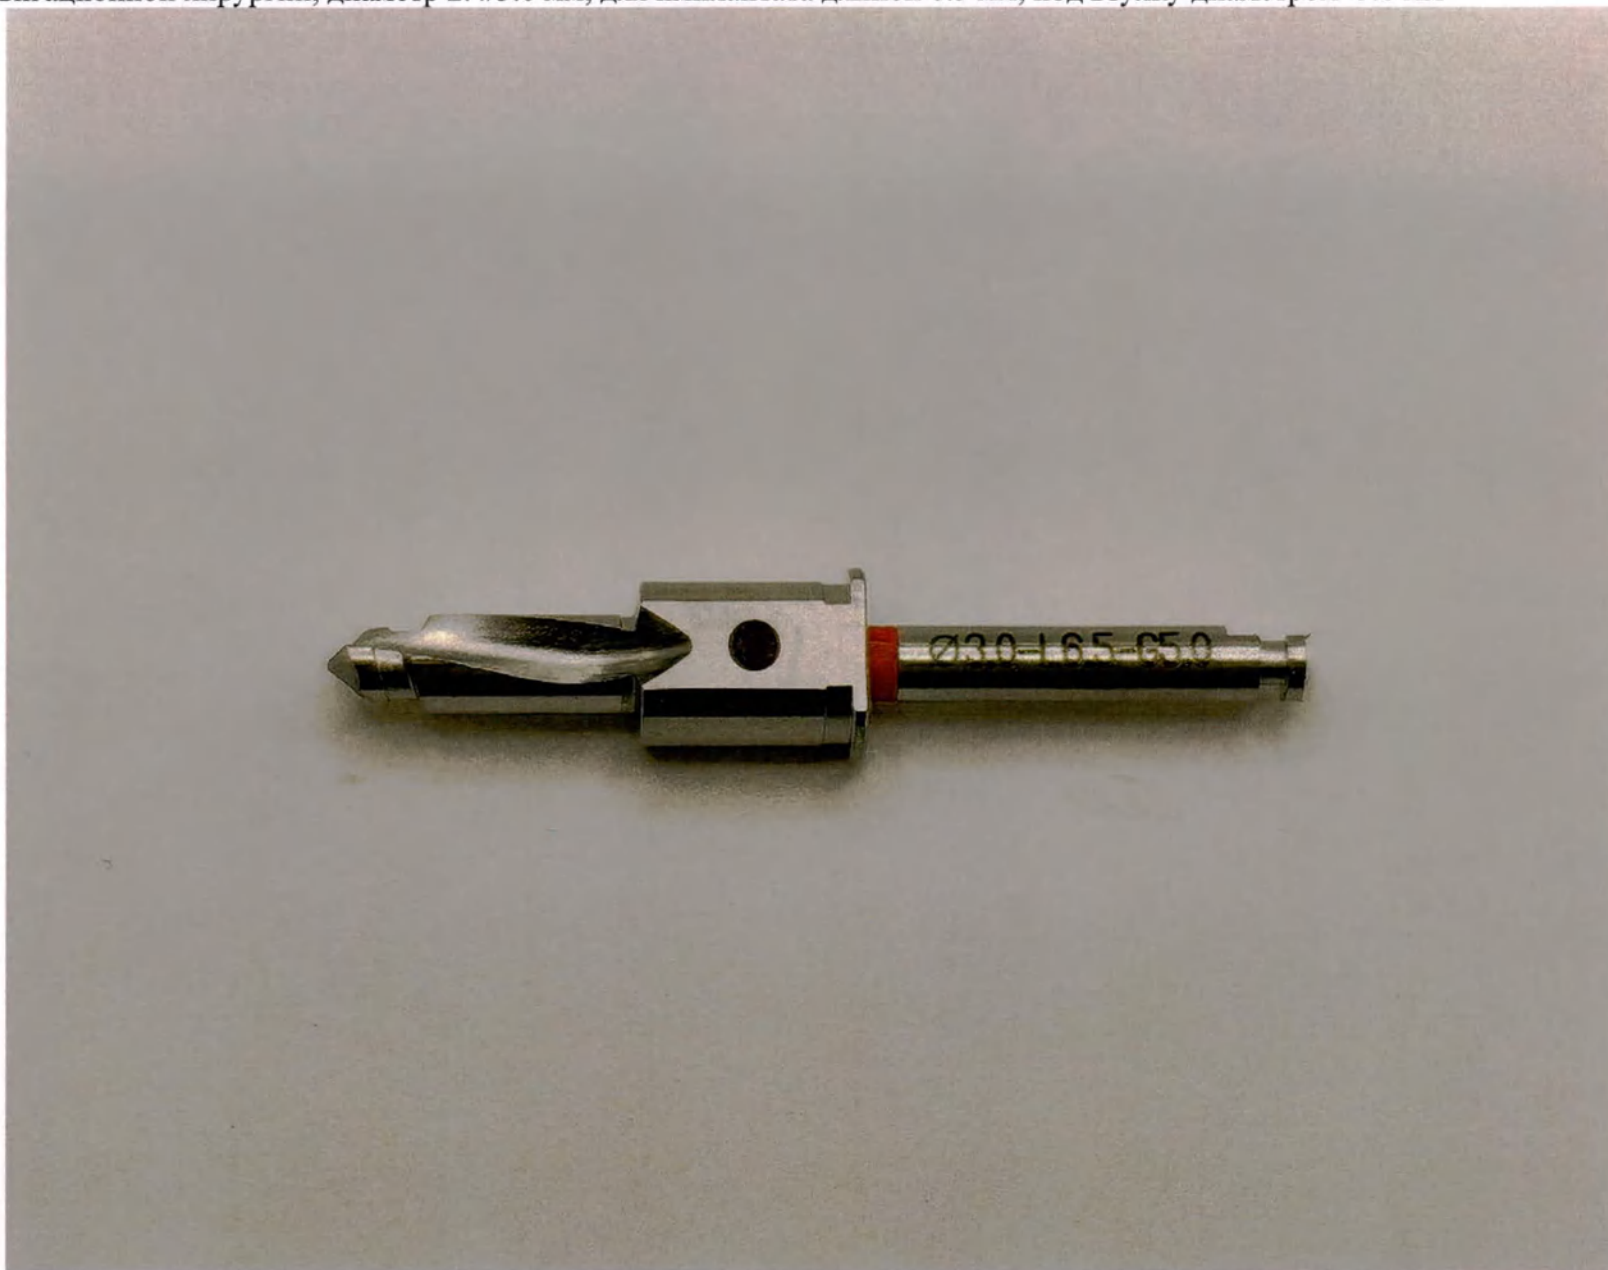

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

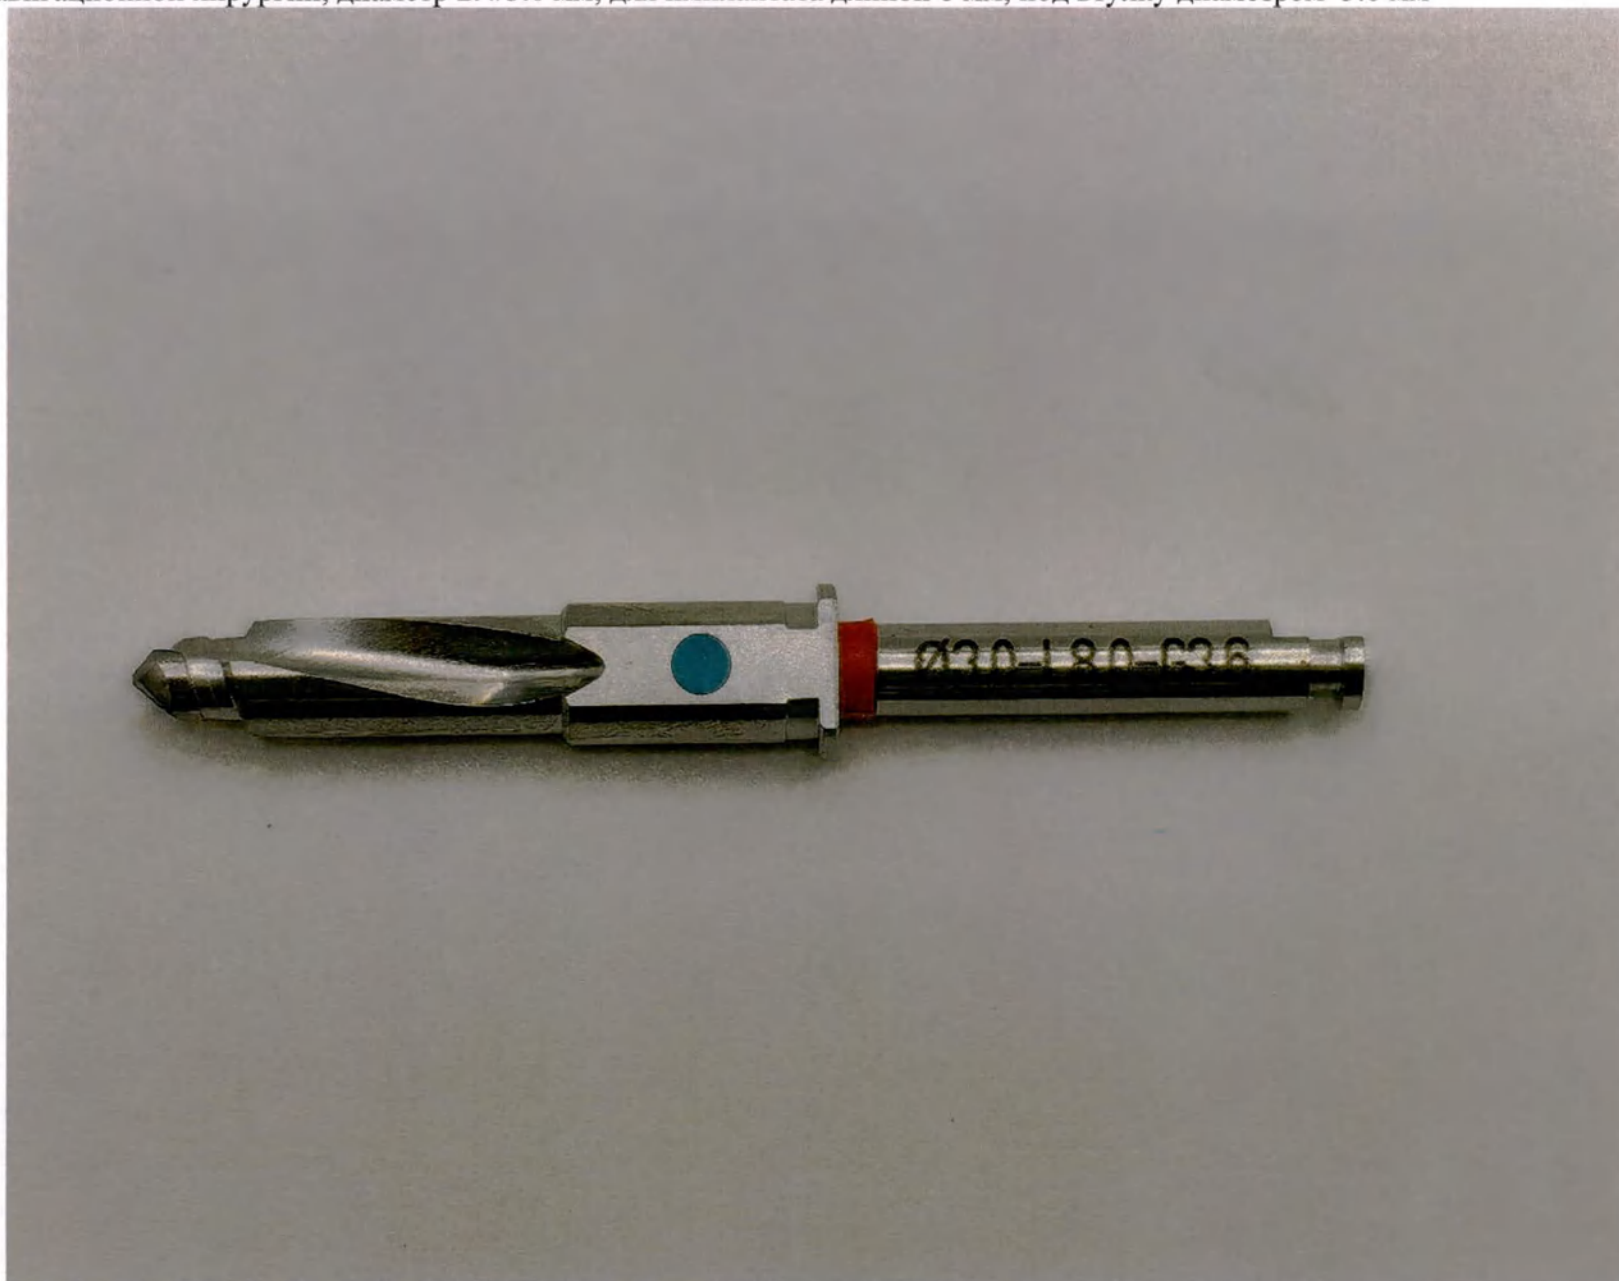

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм

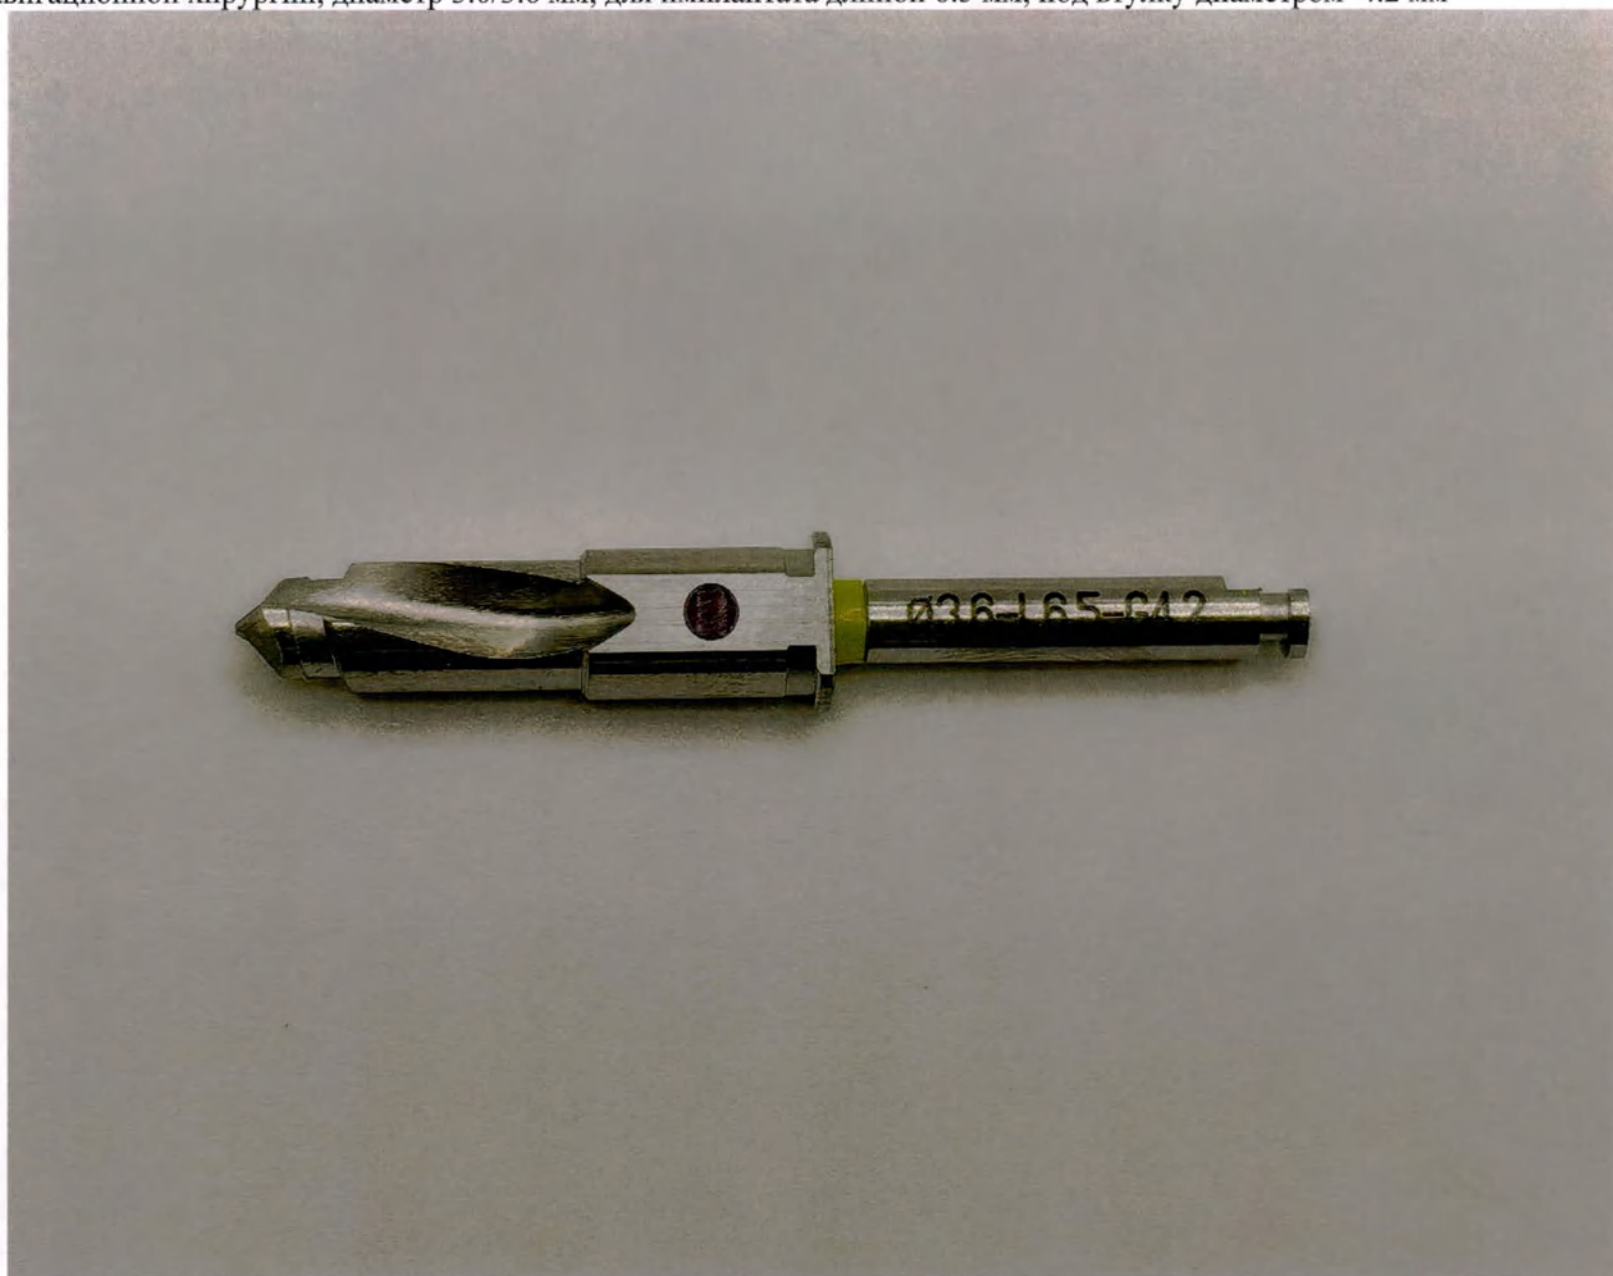


Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

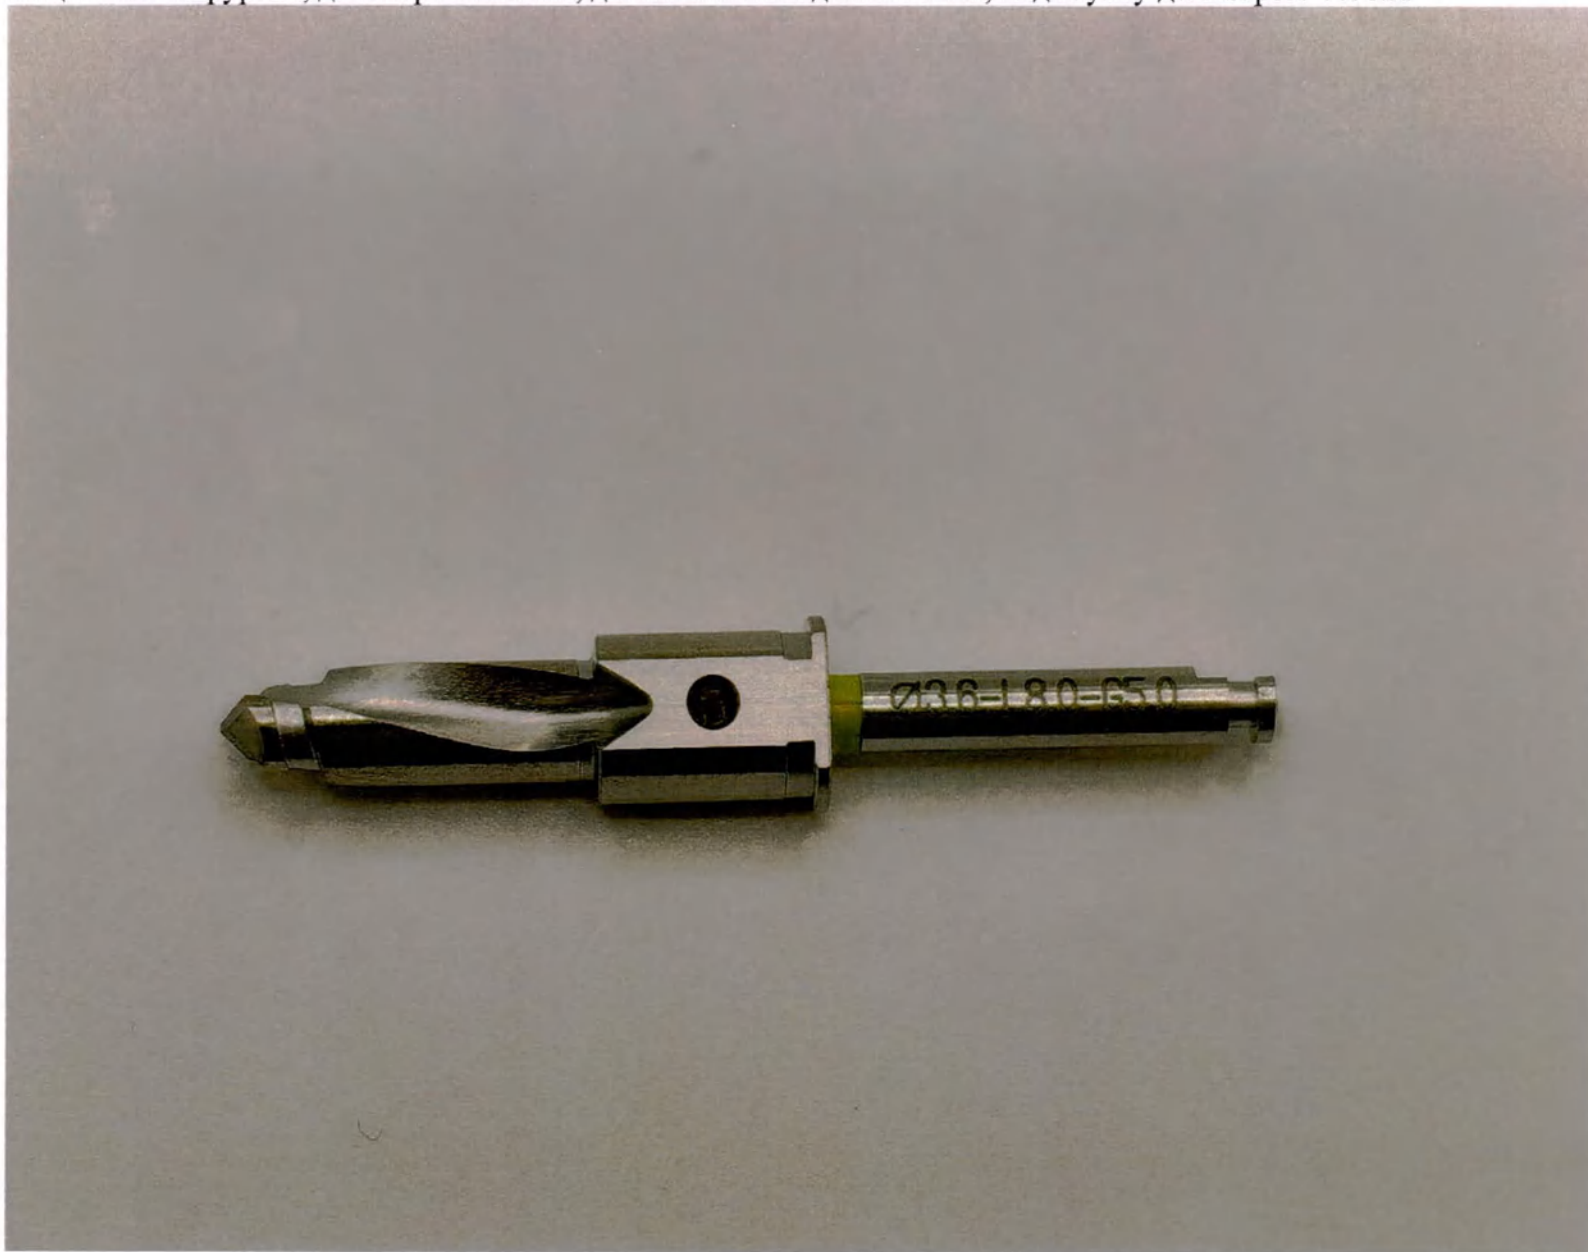

Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм

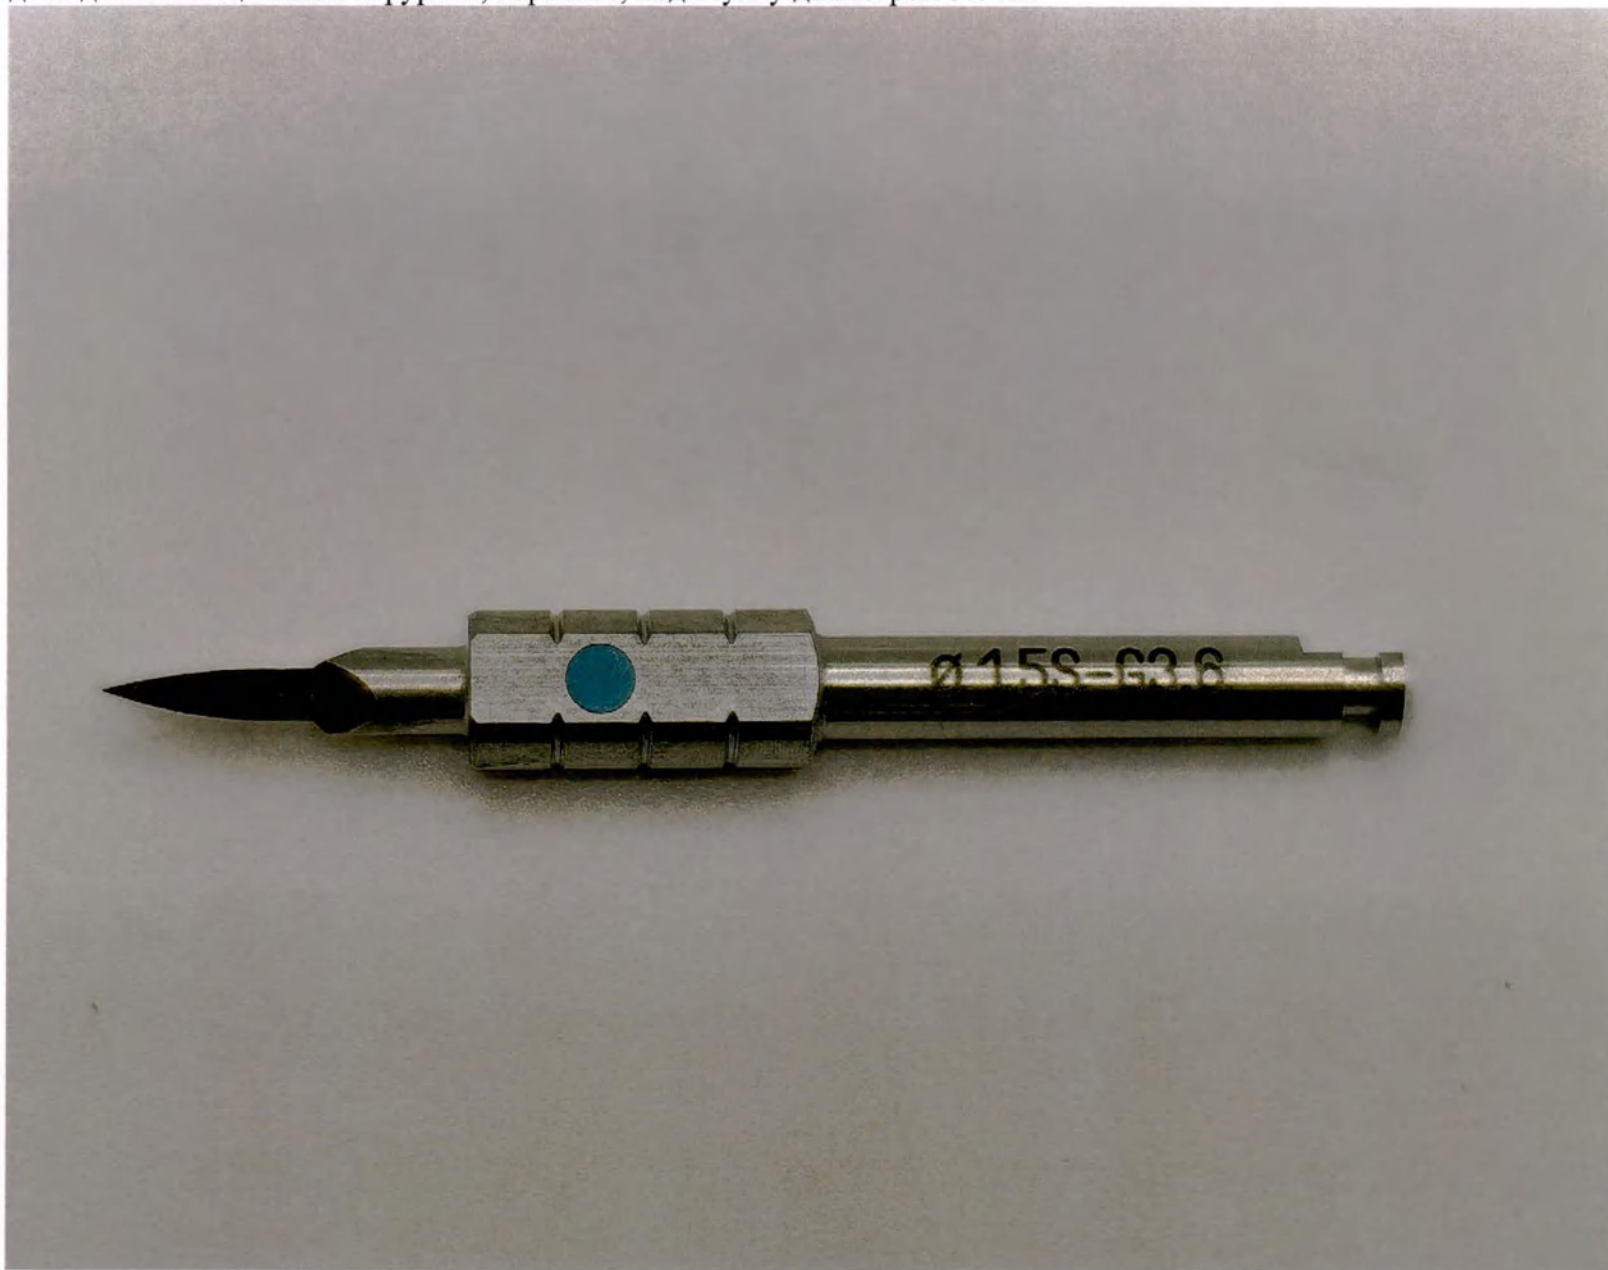


Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм

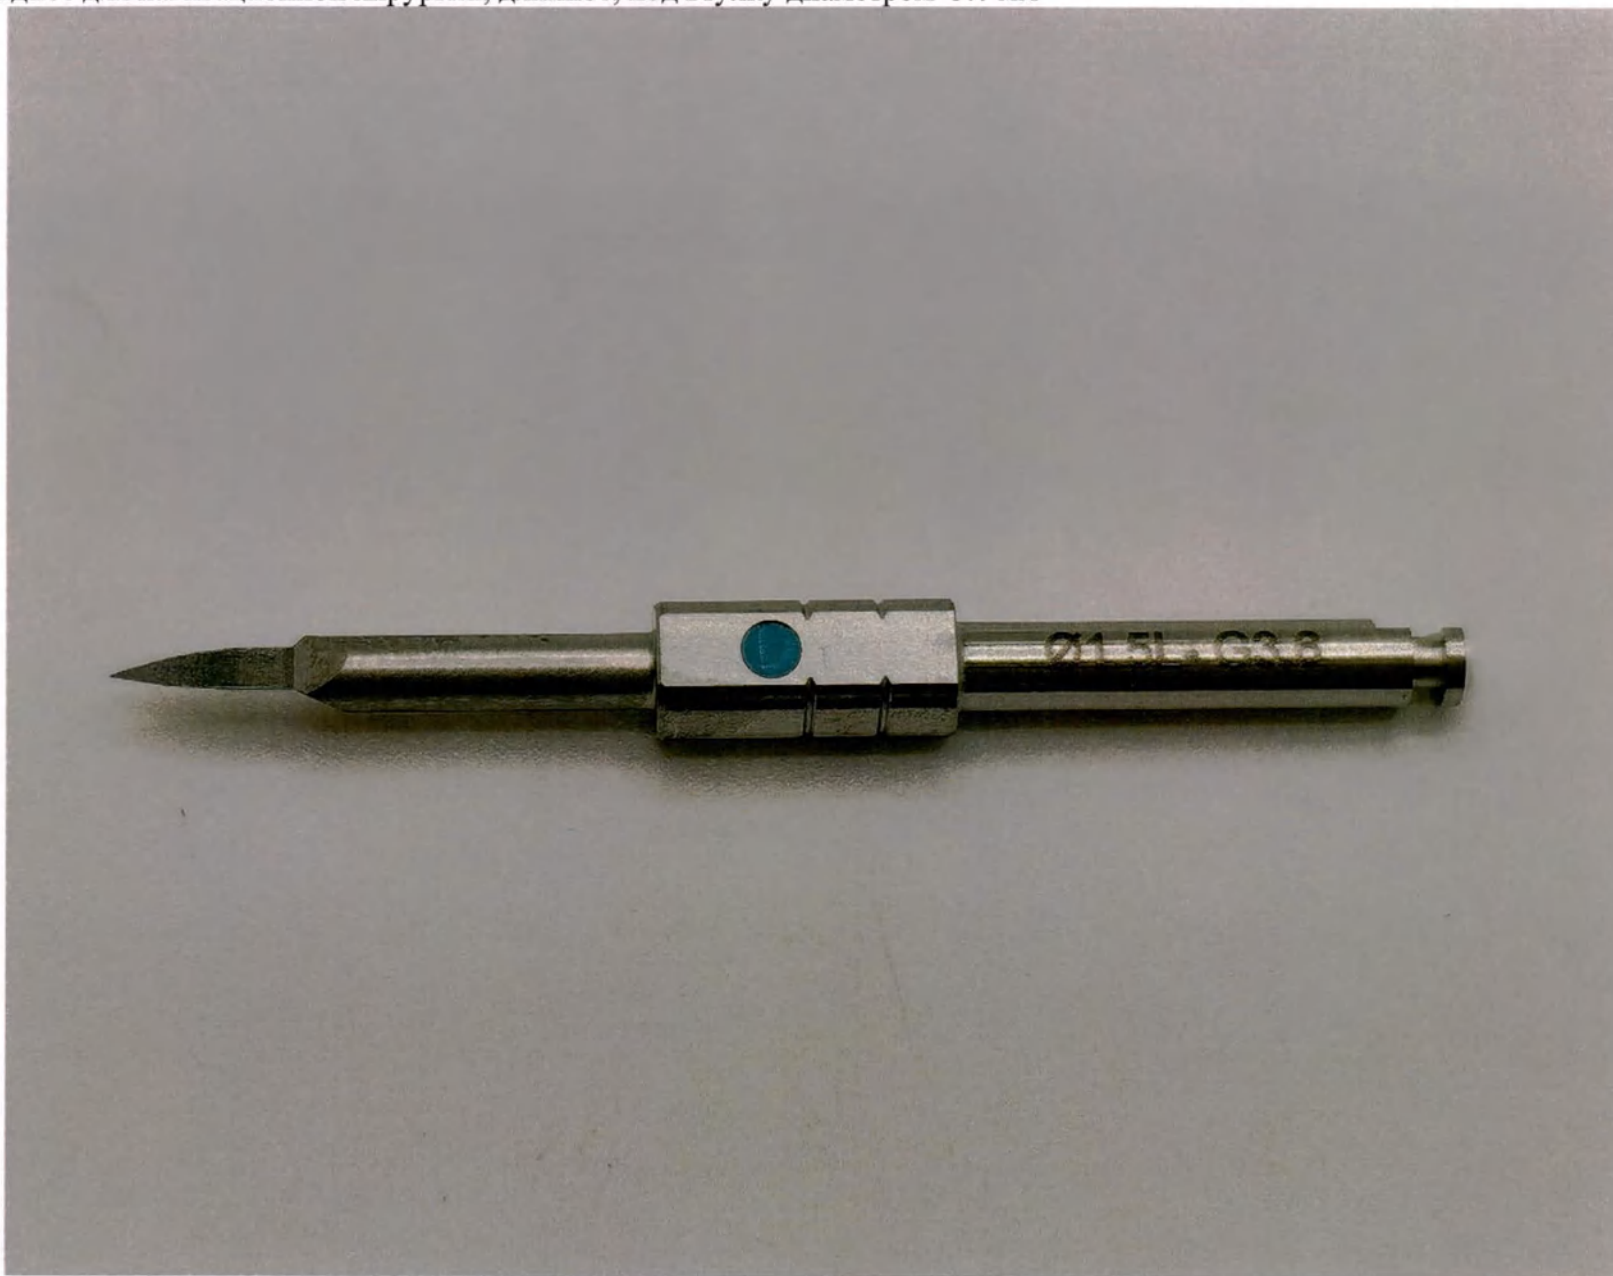

Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм

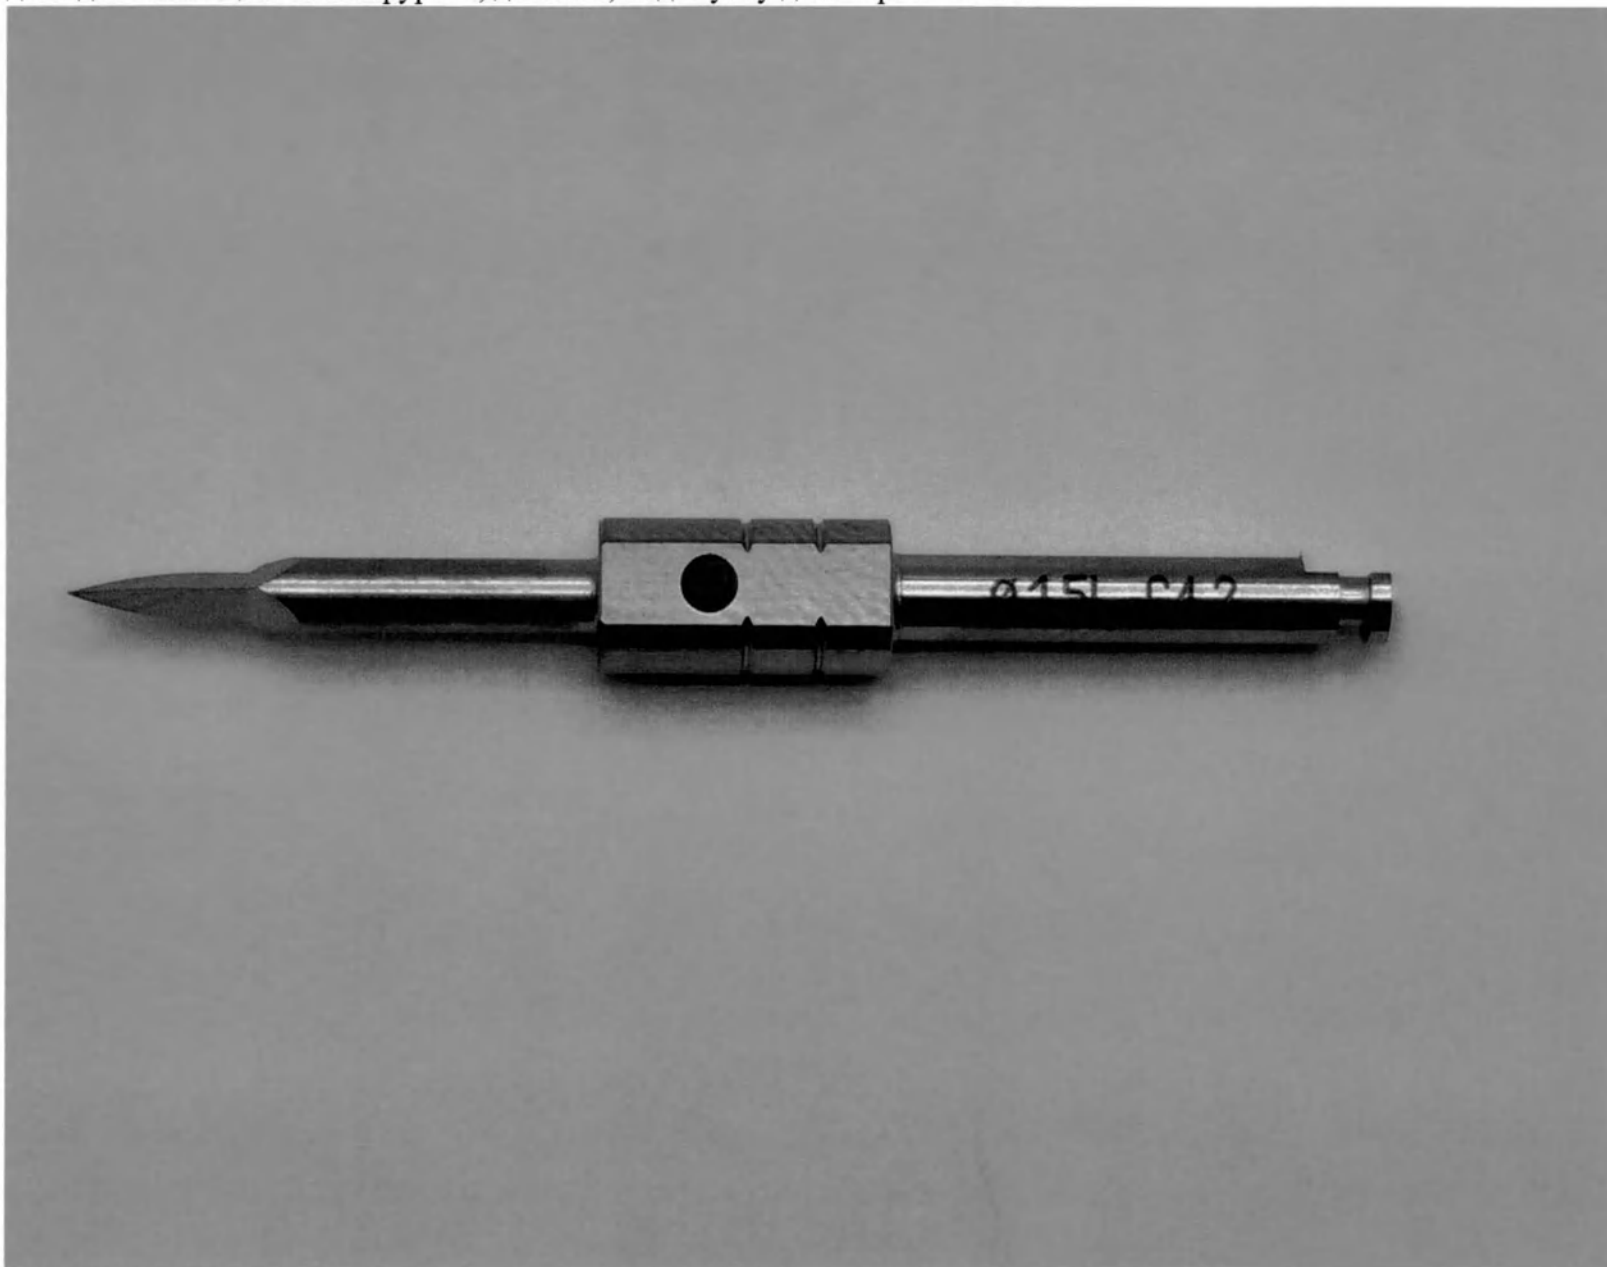

Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 5.0 мм

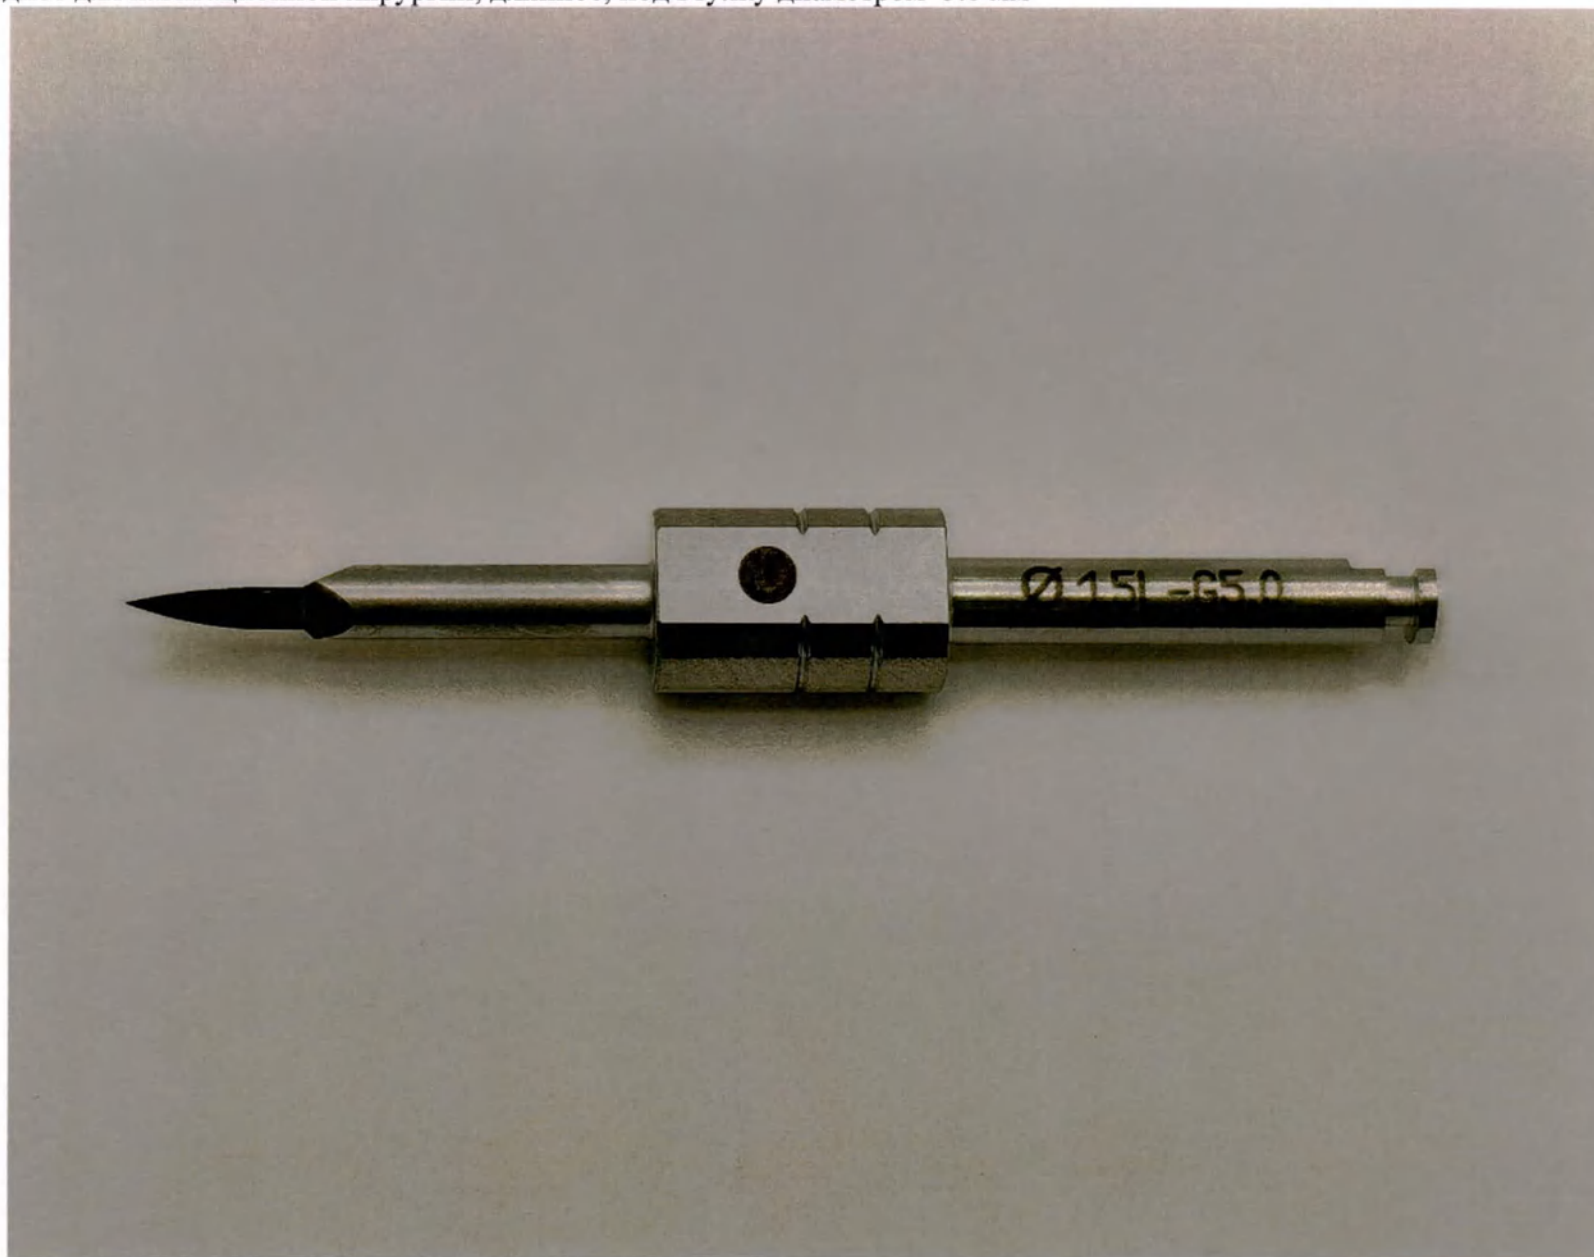


Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм




Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм

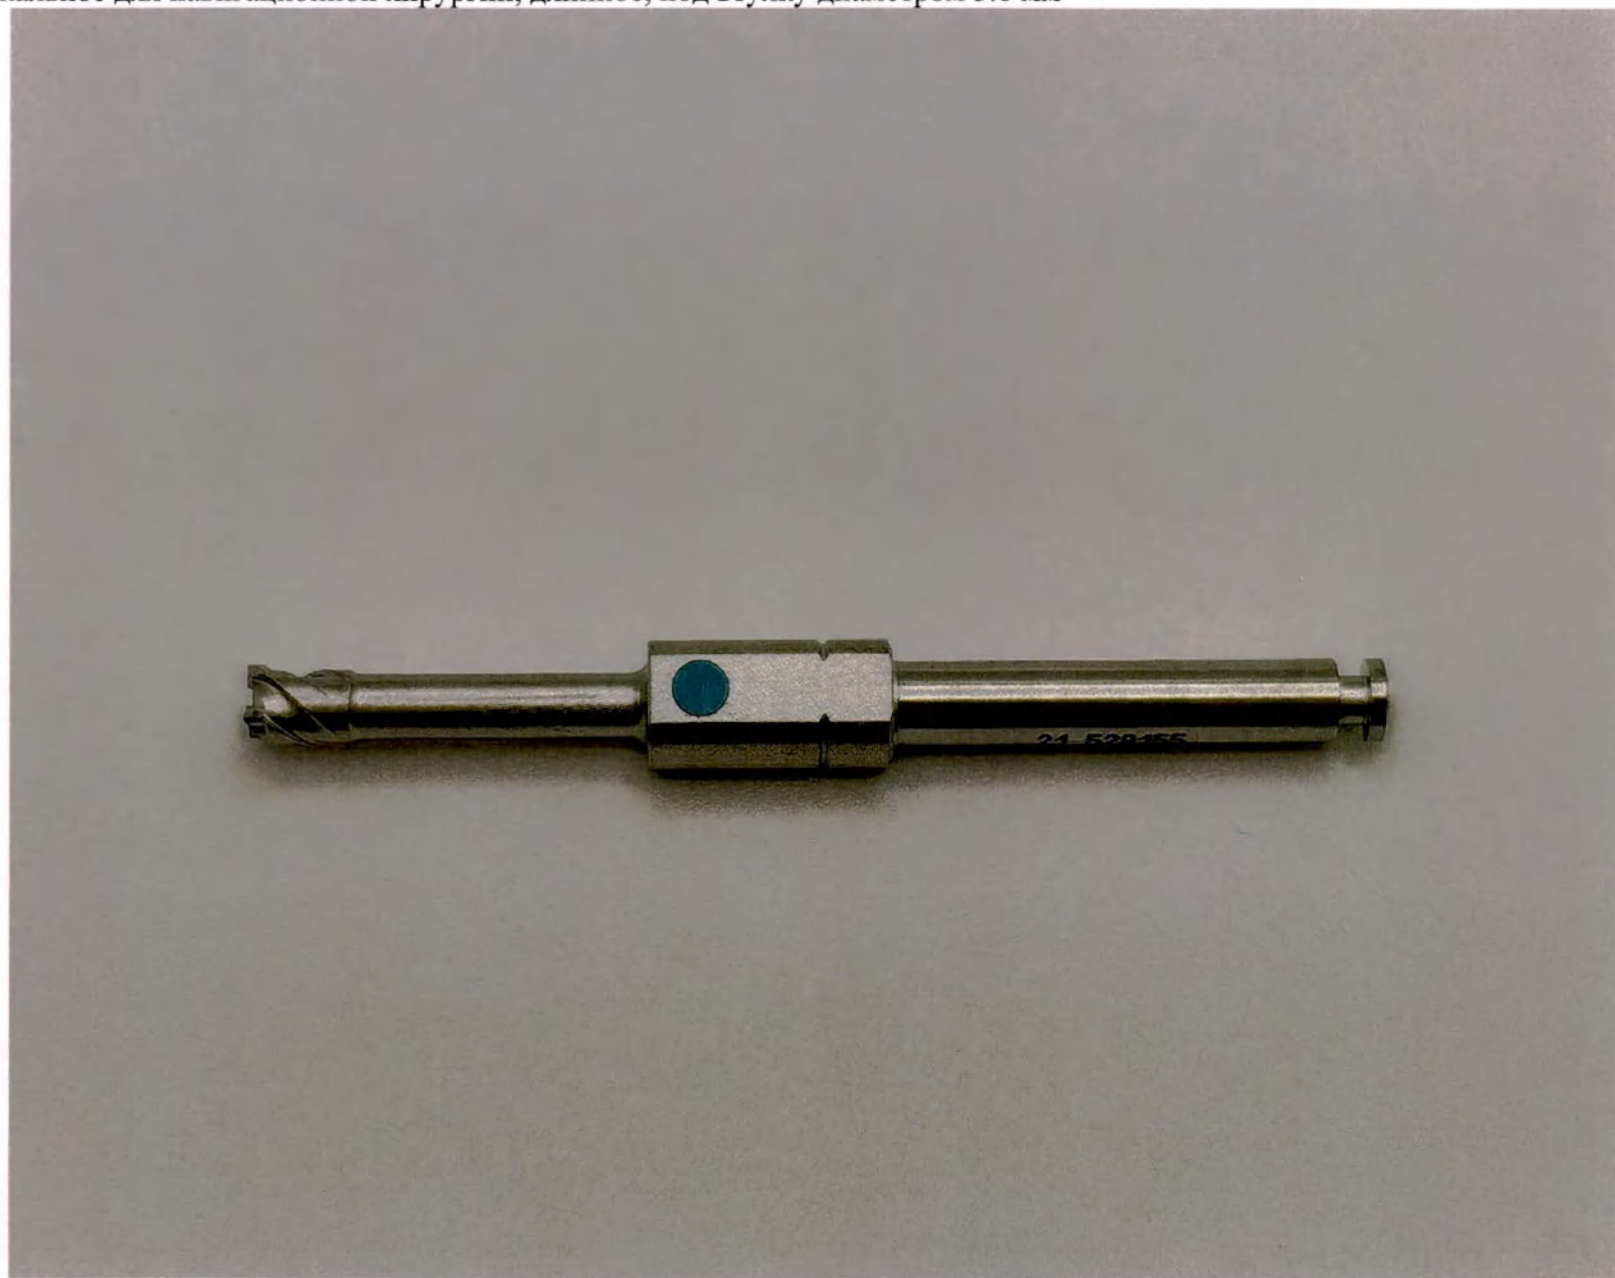


Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм

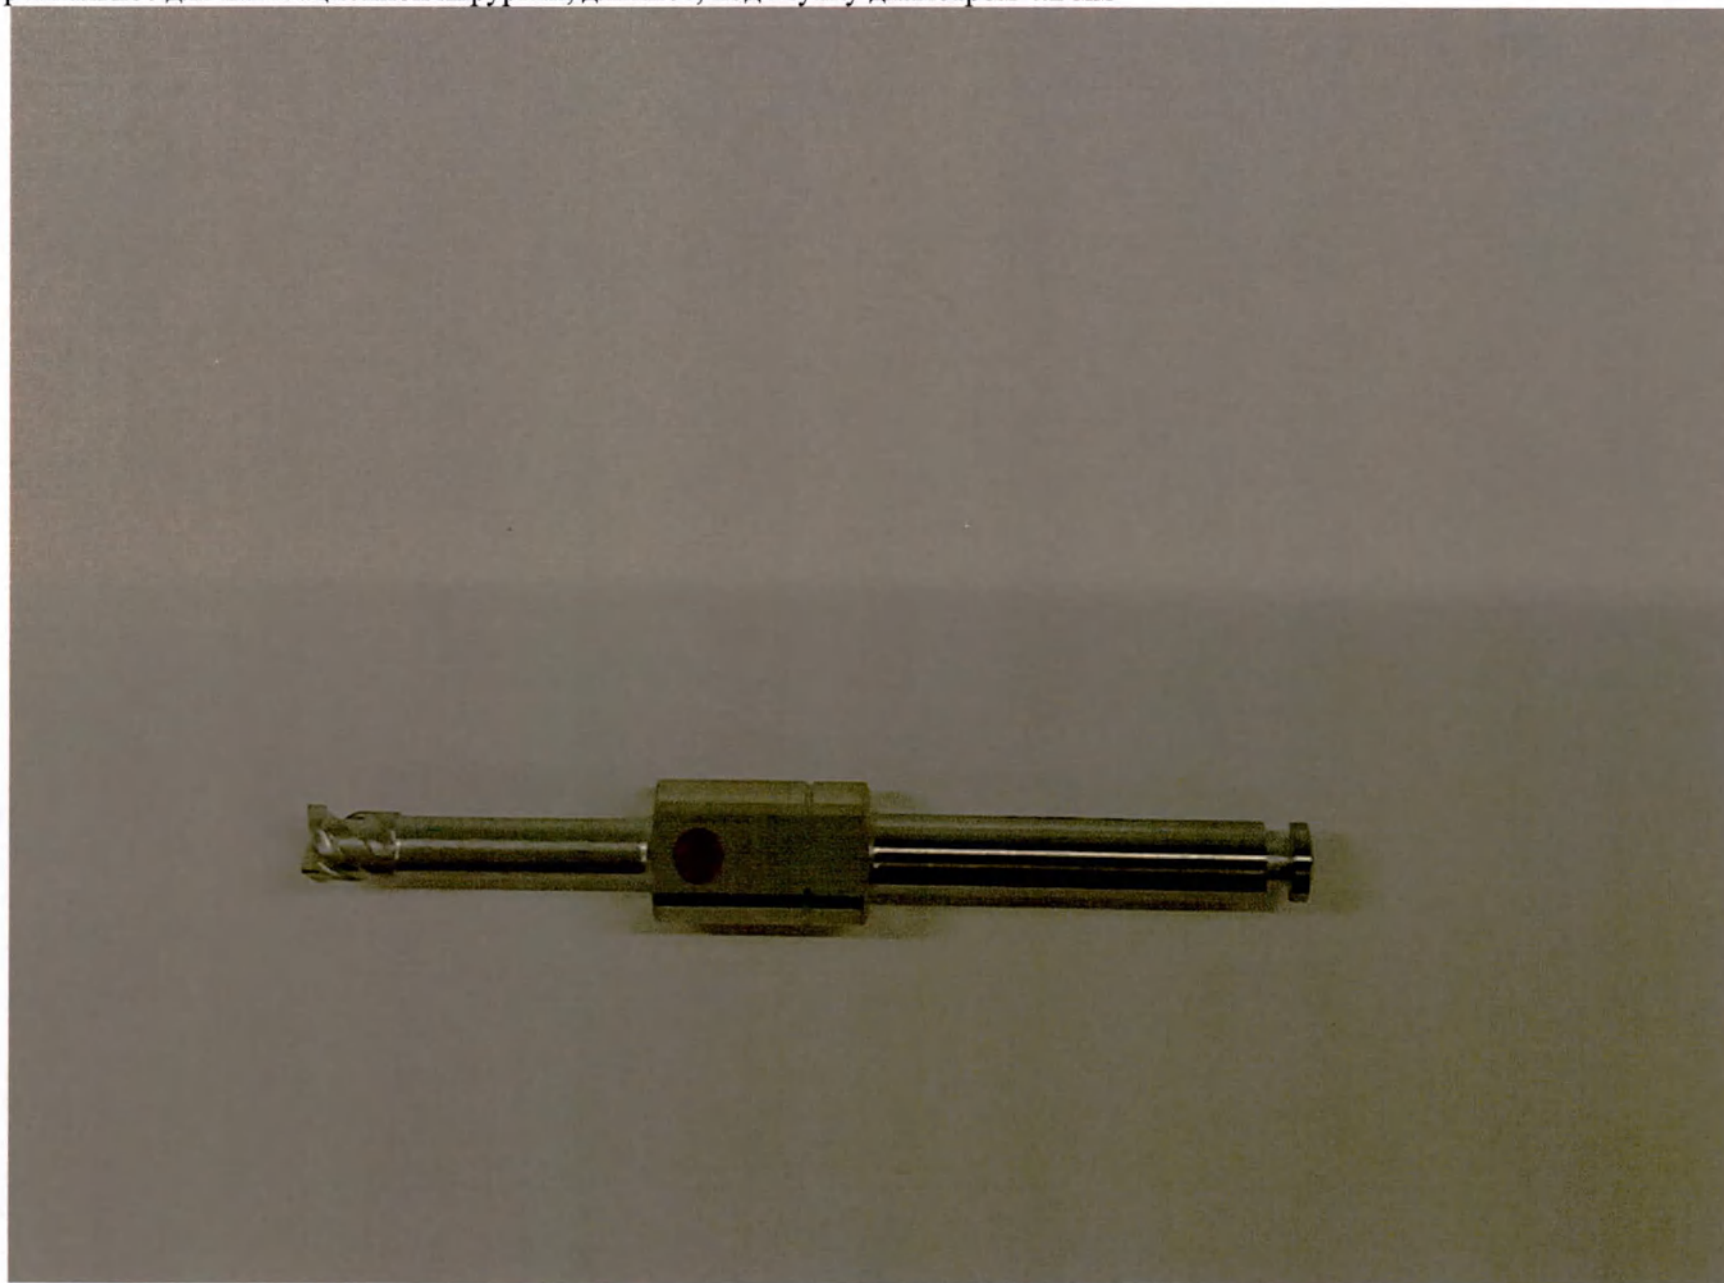


Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 5.0 мм

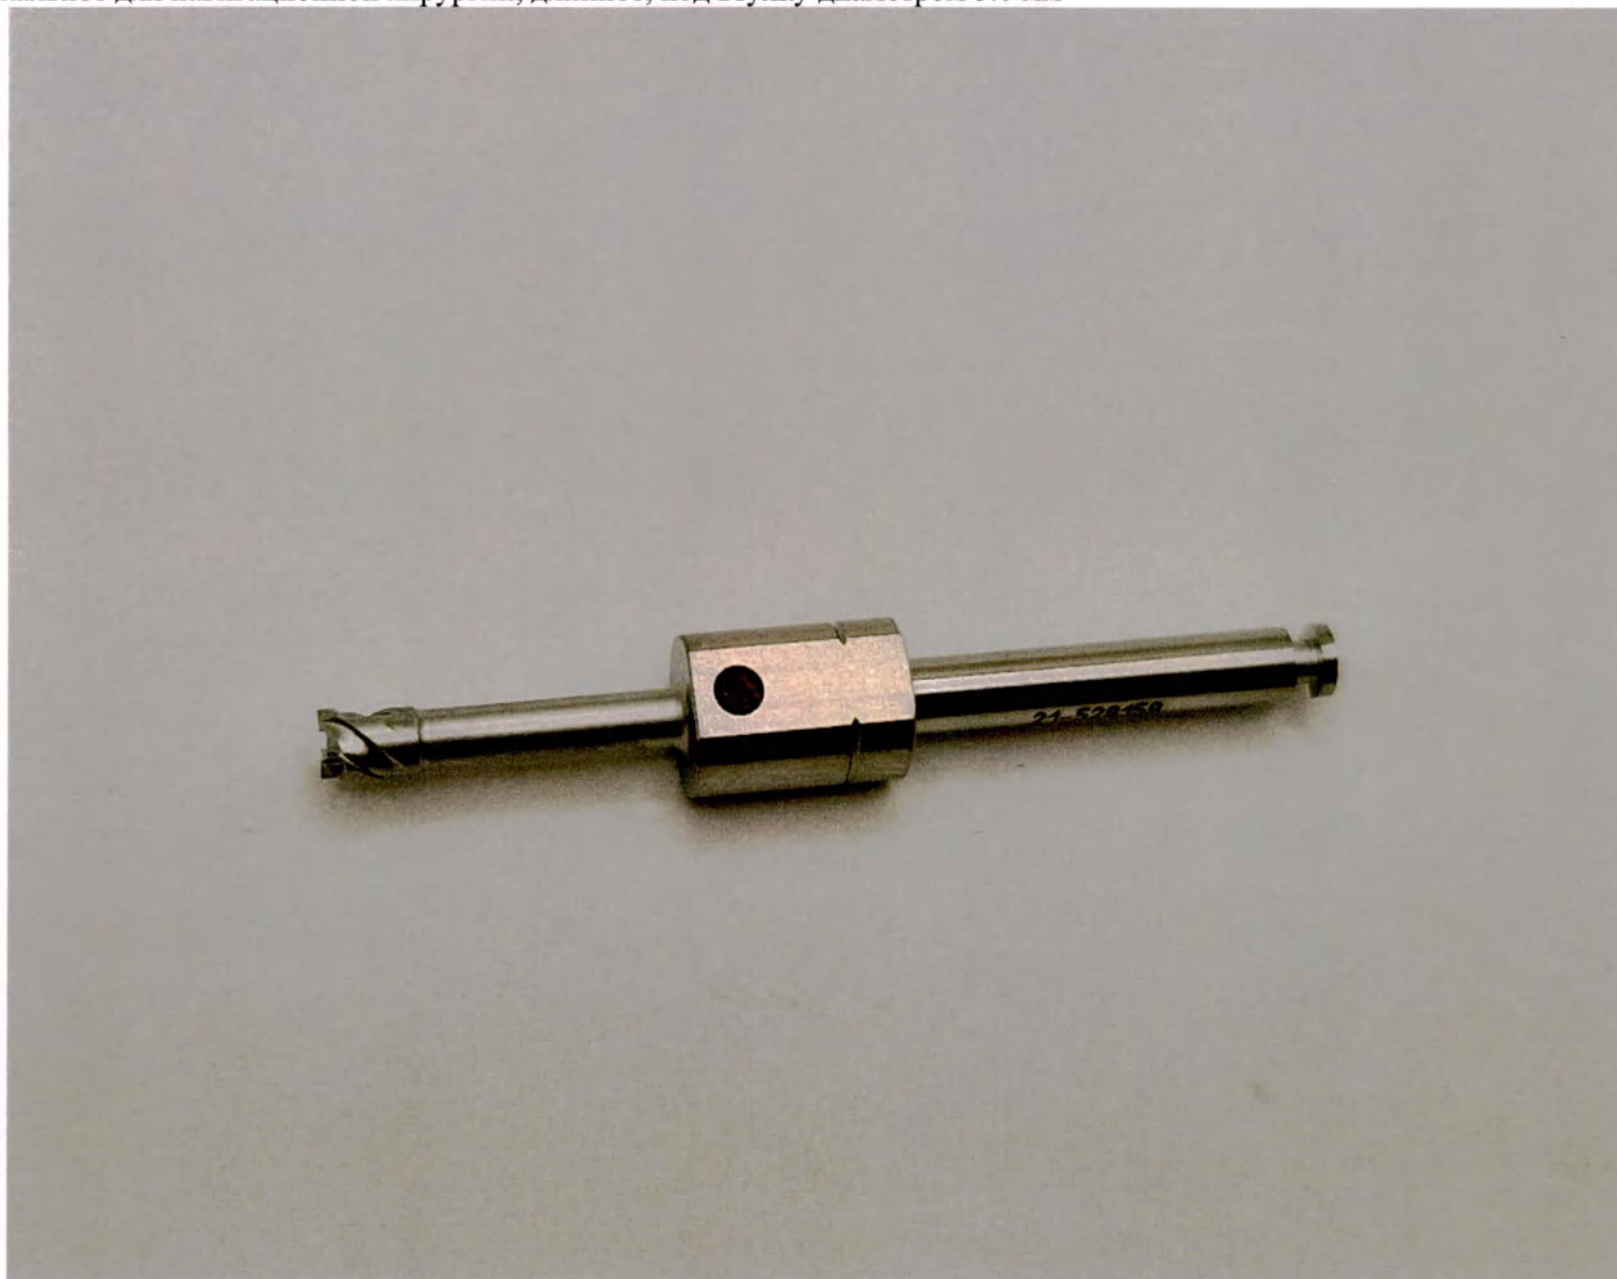


Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм

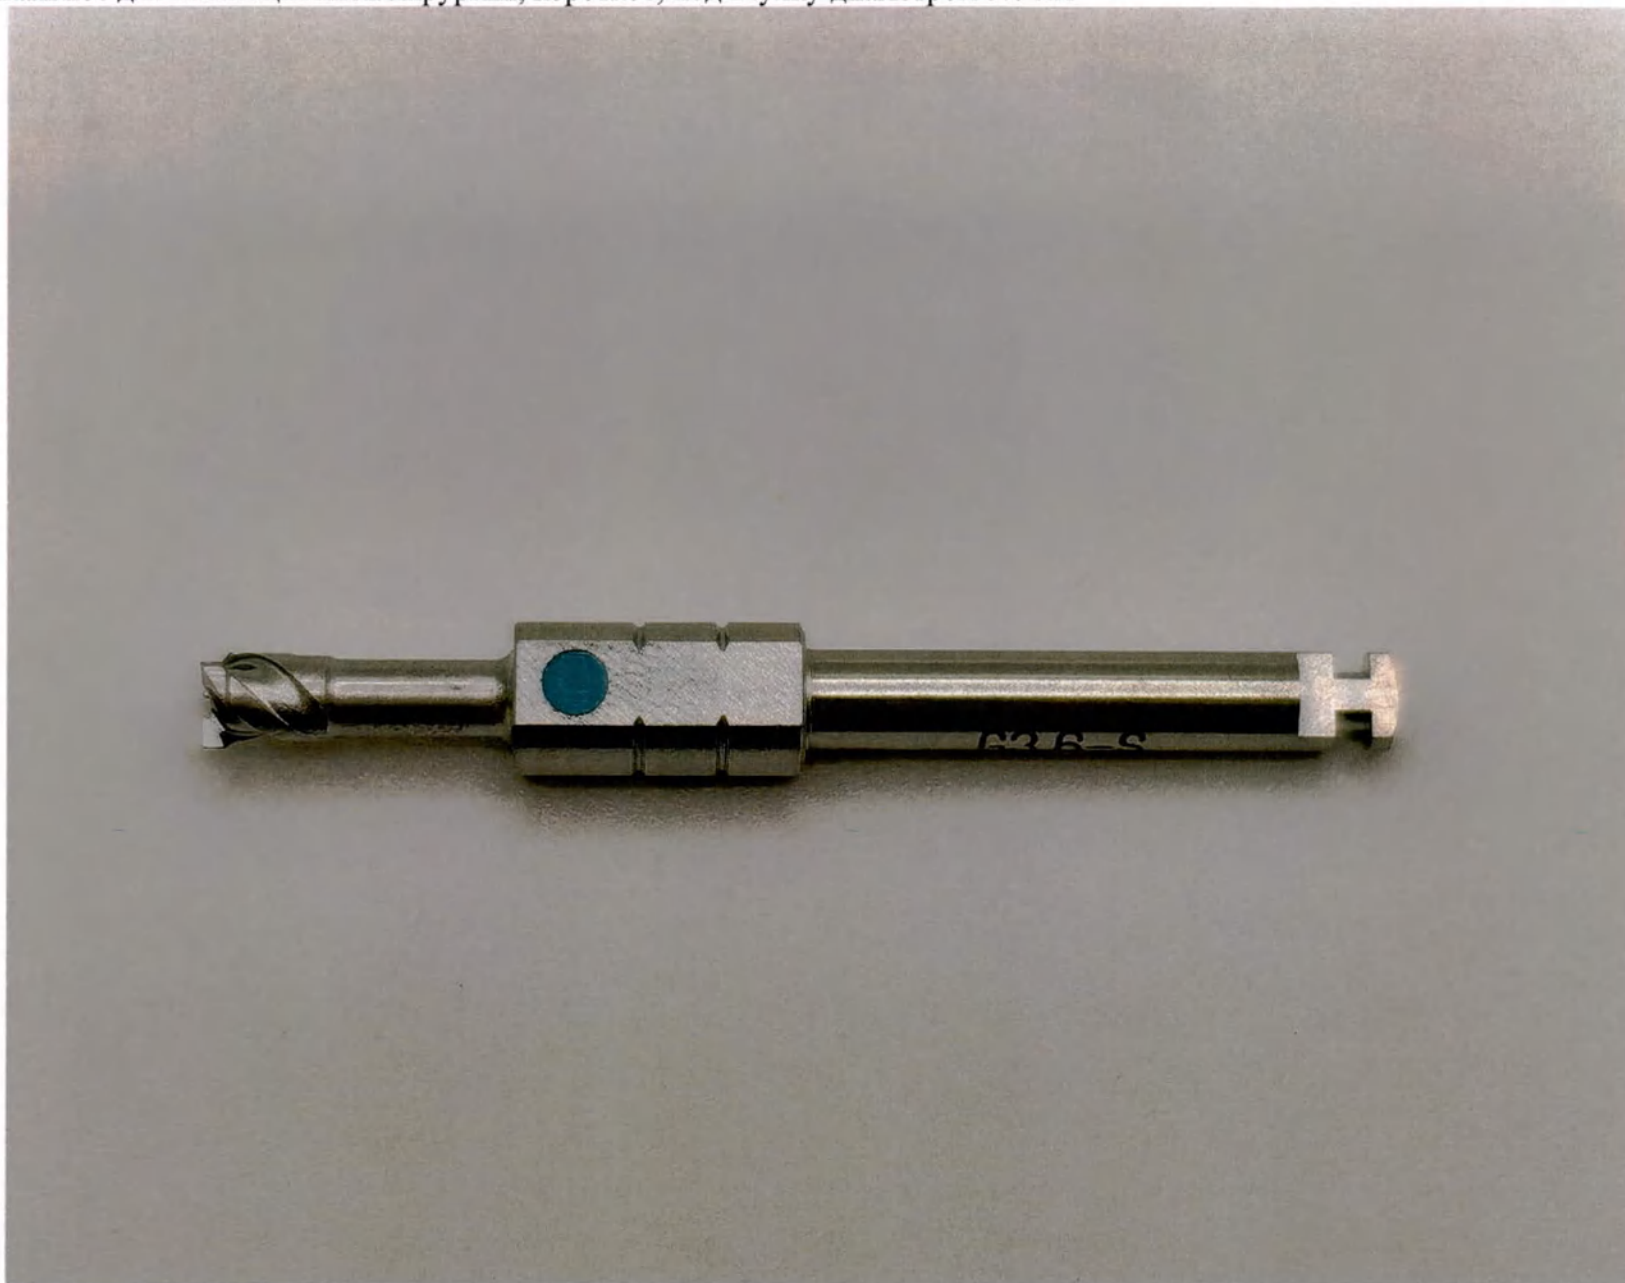

Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм

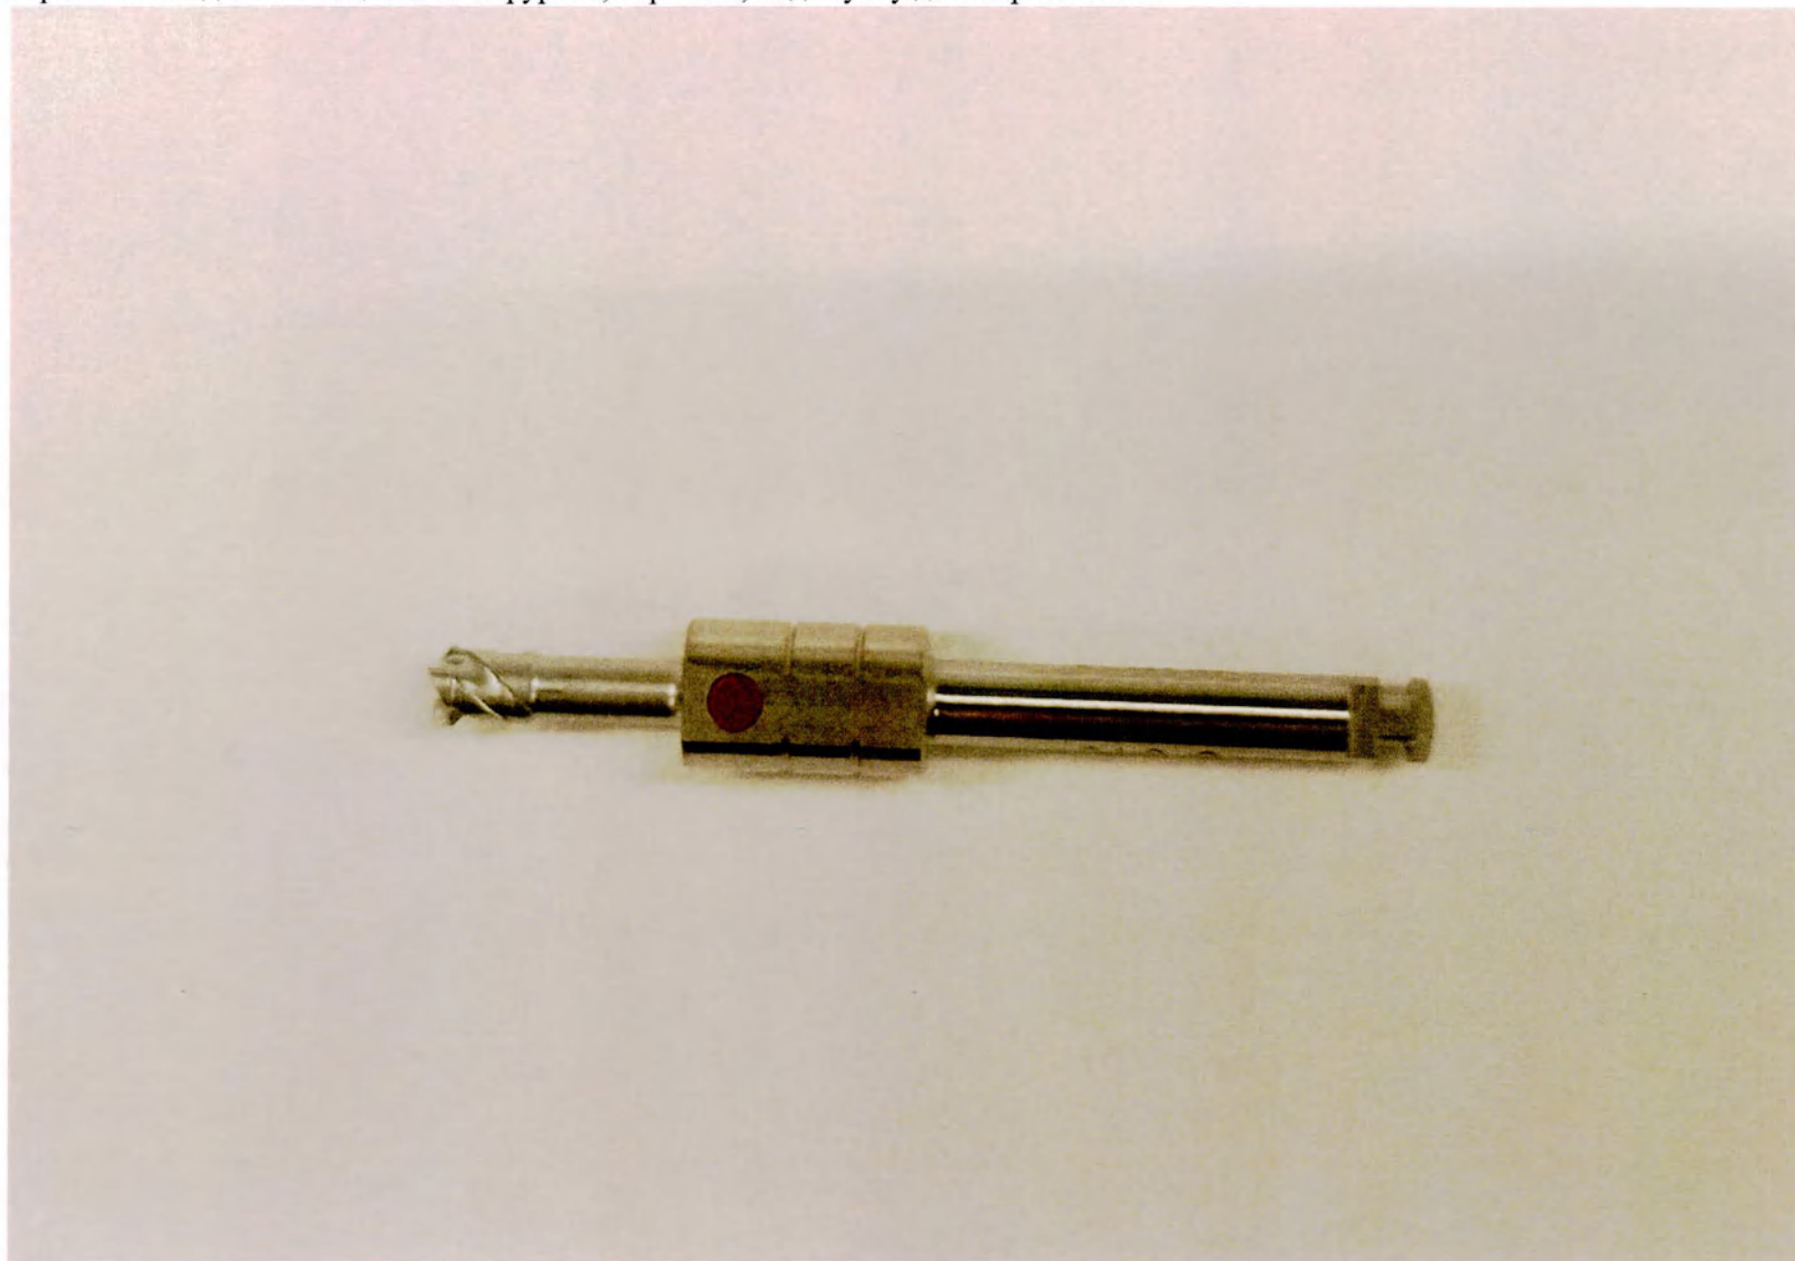


Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм

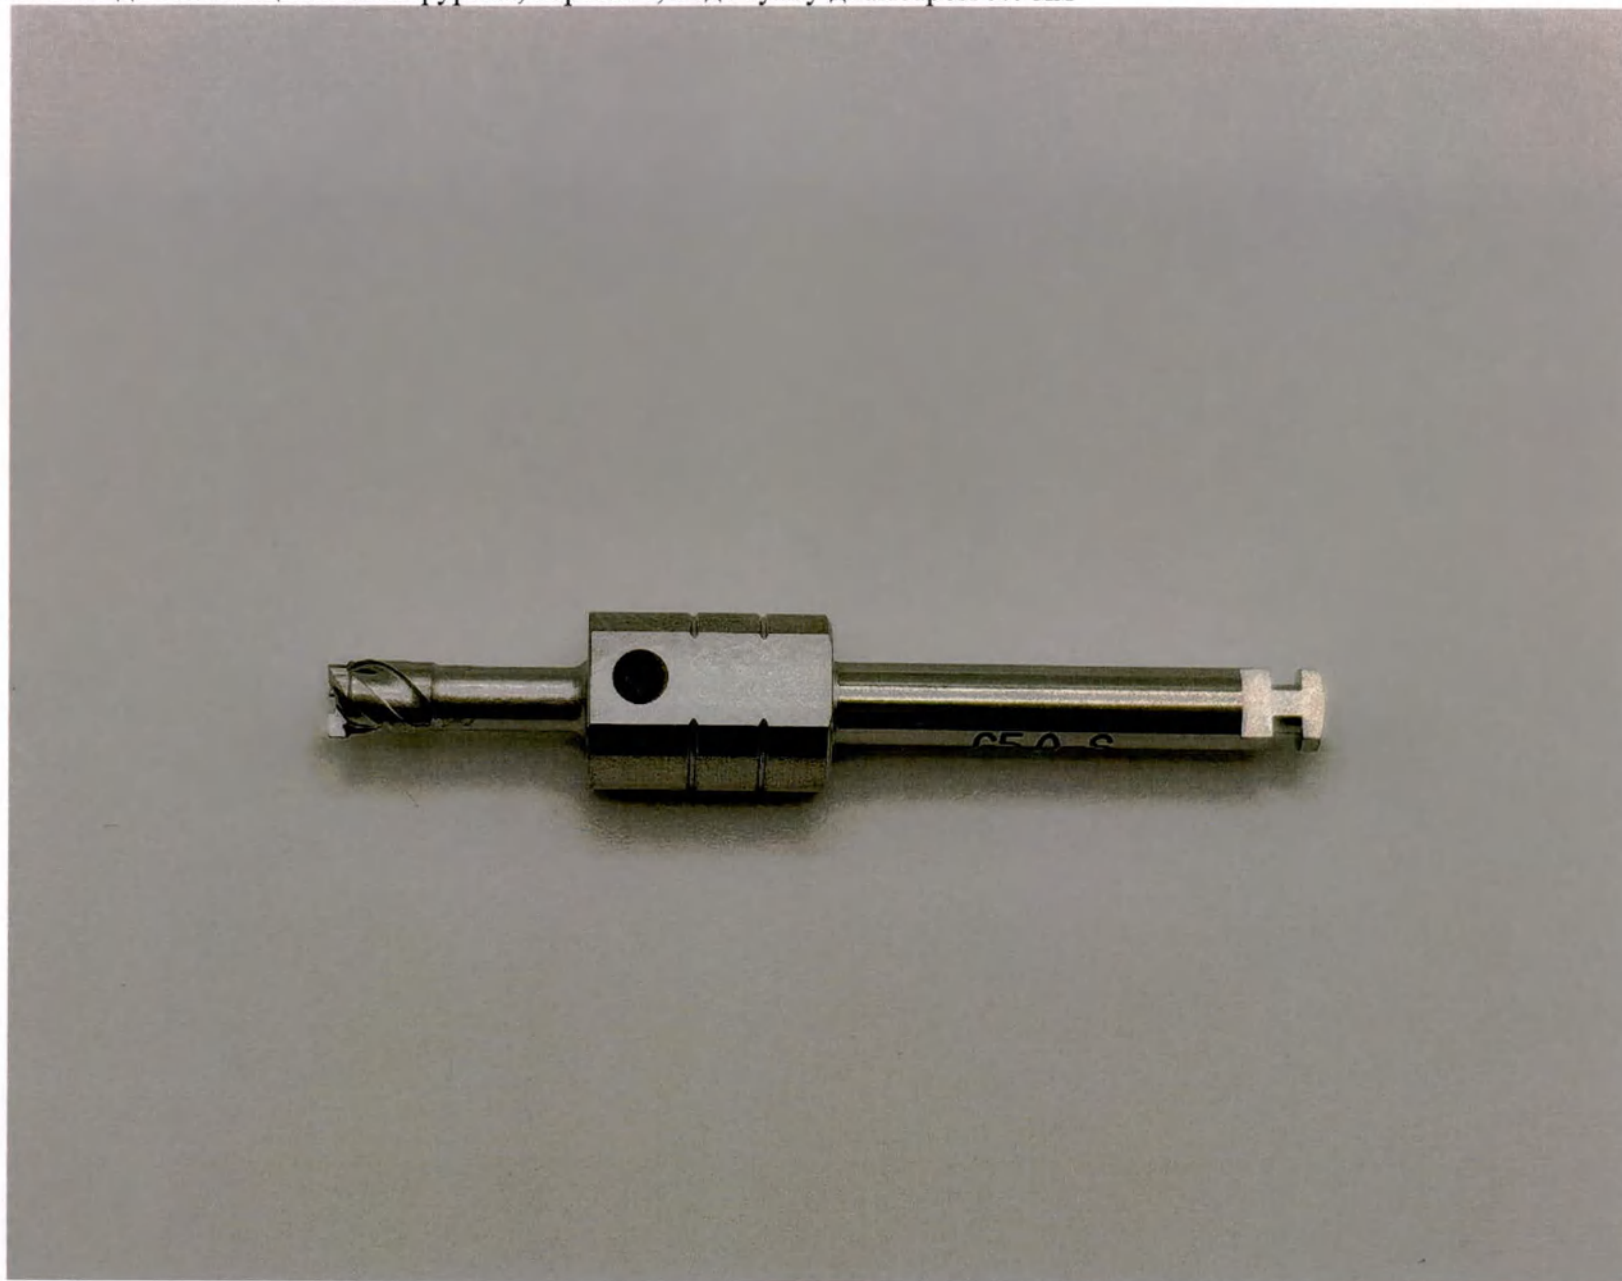

Сверло профильное TL, диаметр 2.4 мм, платформа N 4.0 мм



Сверло профильное TL, диаметр 2.4 мм, платформа R 4.8 мм



Сверло профильное TL, диаметр 3.0 мм, платформа N 4.0 мм



Сверло профильное TL, диаметр 3.0 мм, платформа R 4.8 мм




Сверло профильное TL, диаметр 3.6 мм, платформа N 4.0 мм



Сверло профильное TL, диаметр 3.6 мм, платформа R 4.8 мм




Сверло профильное TL, диаметр 4.2 мм, платформа R 4.8 мм

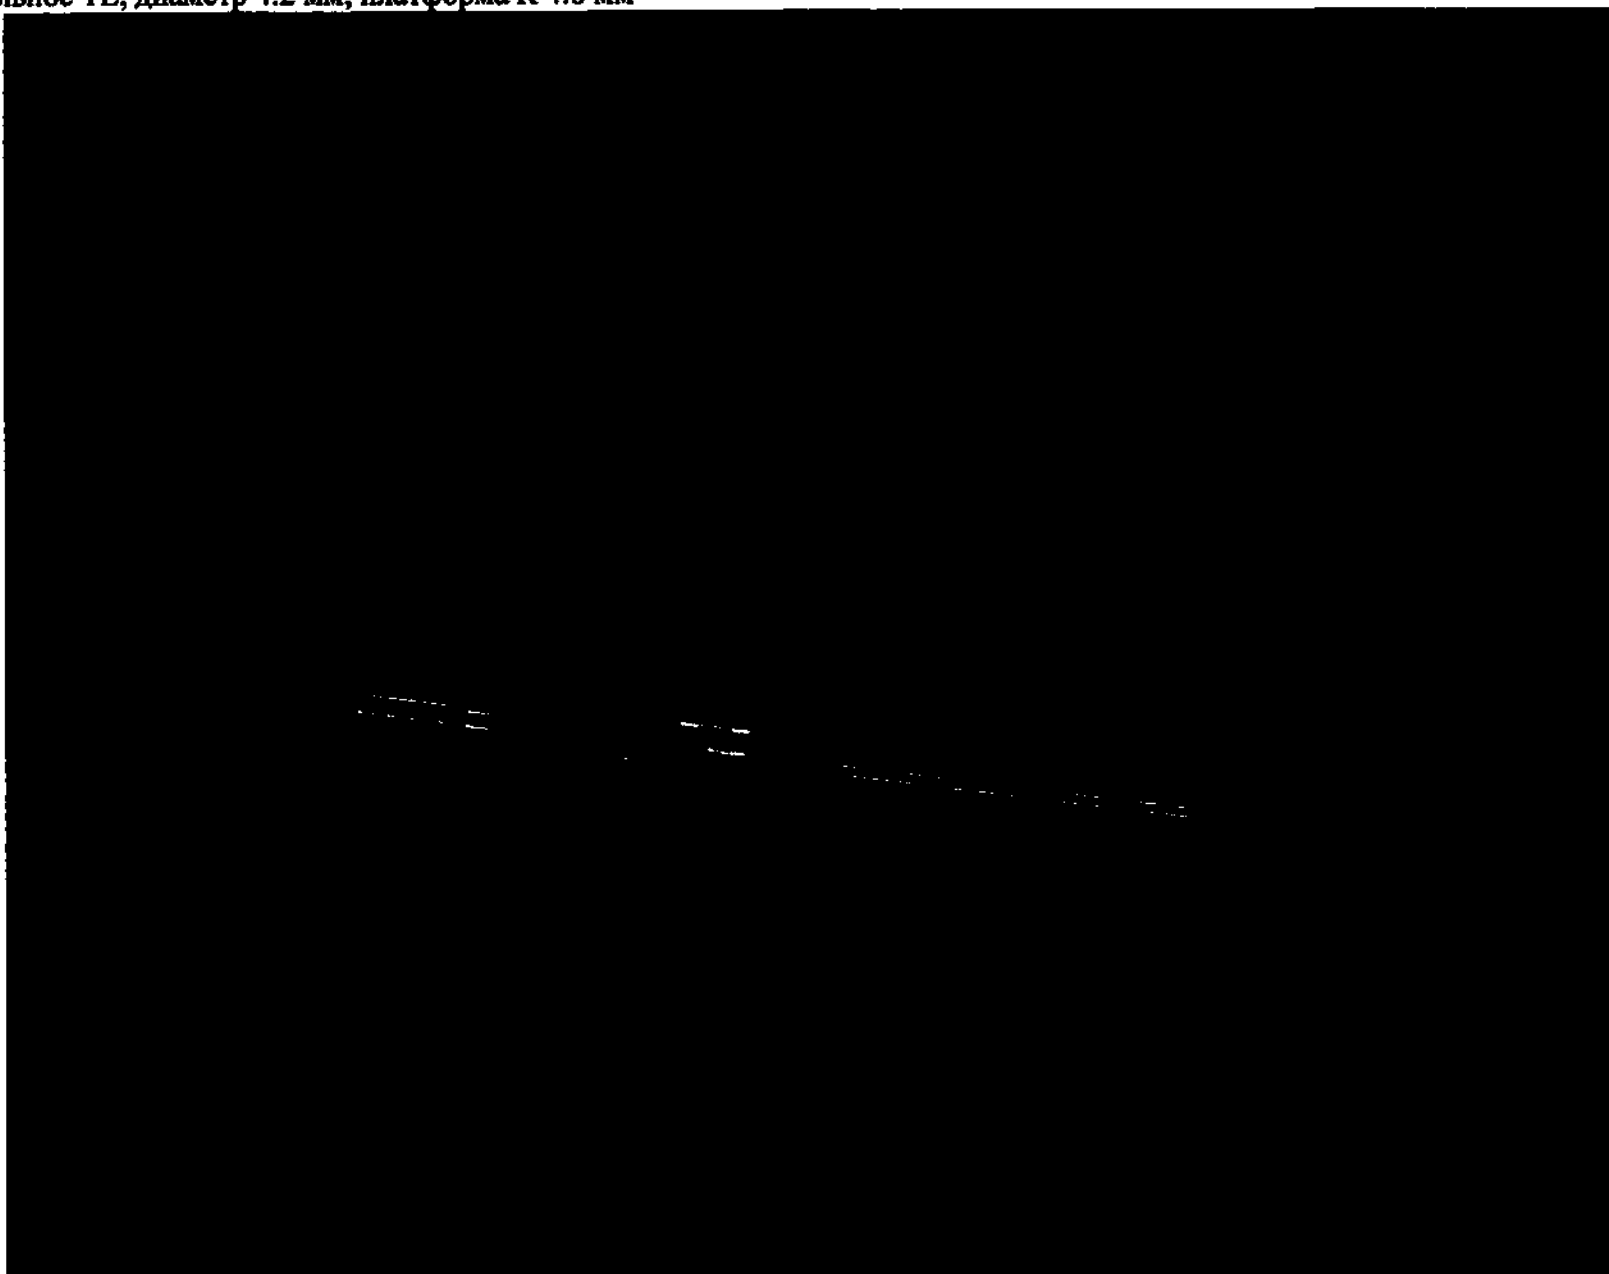

Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

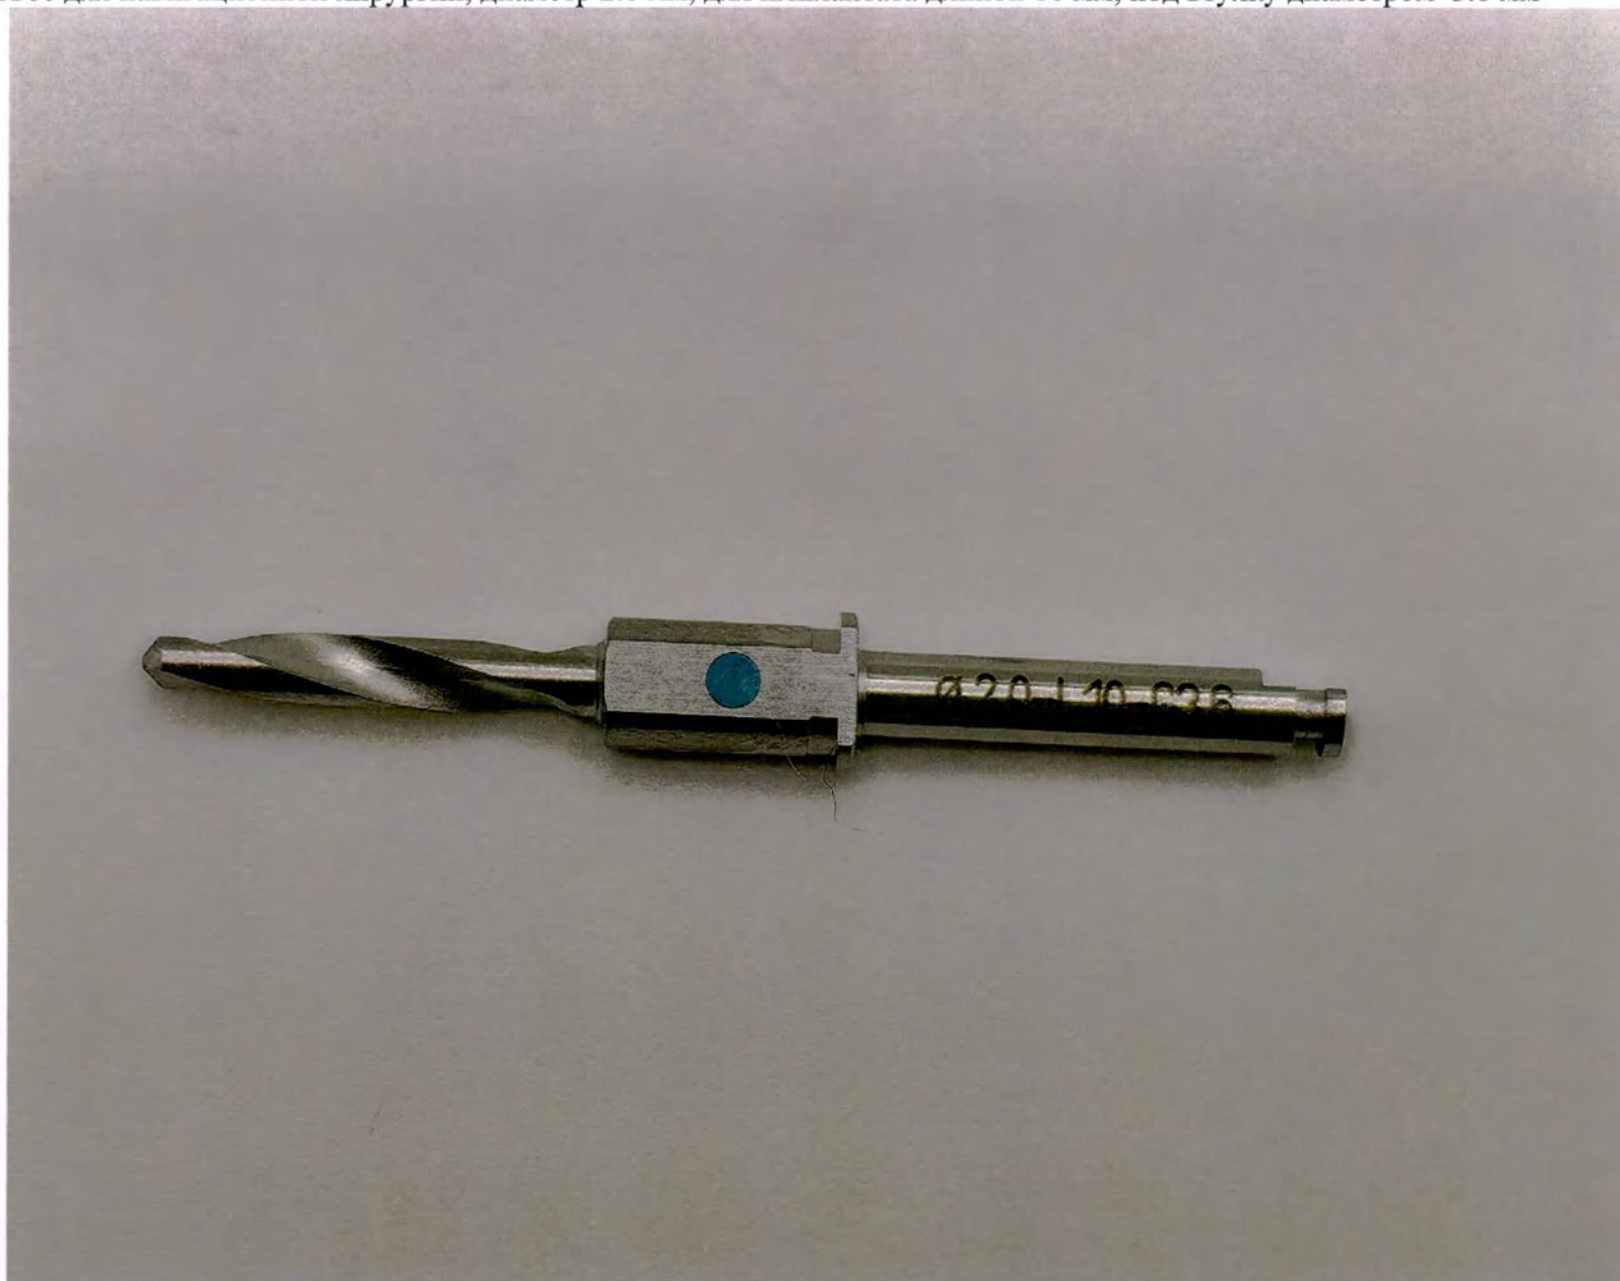


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

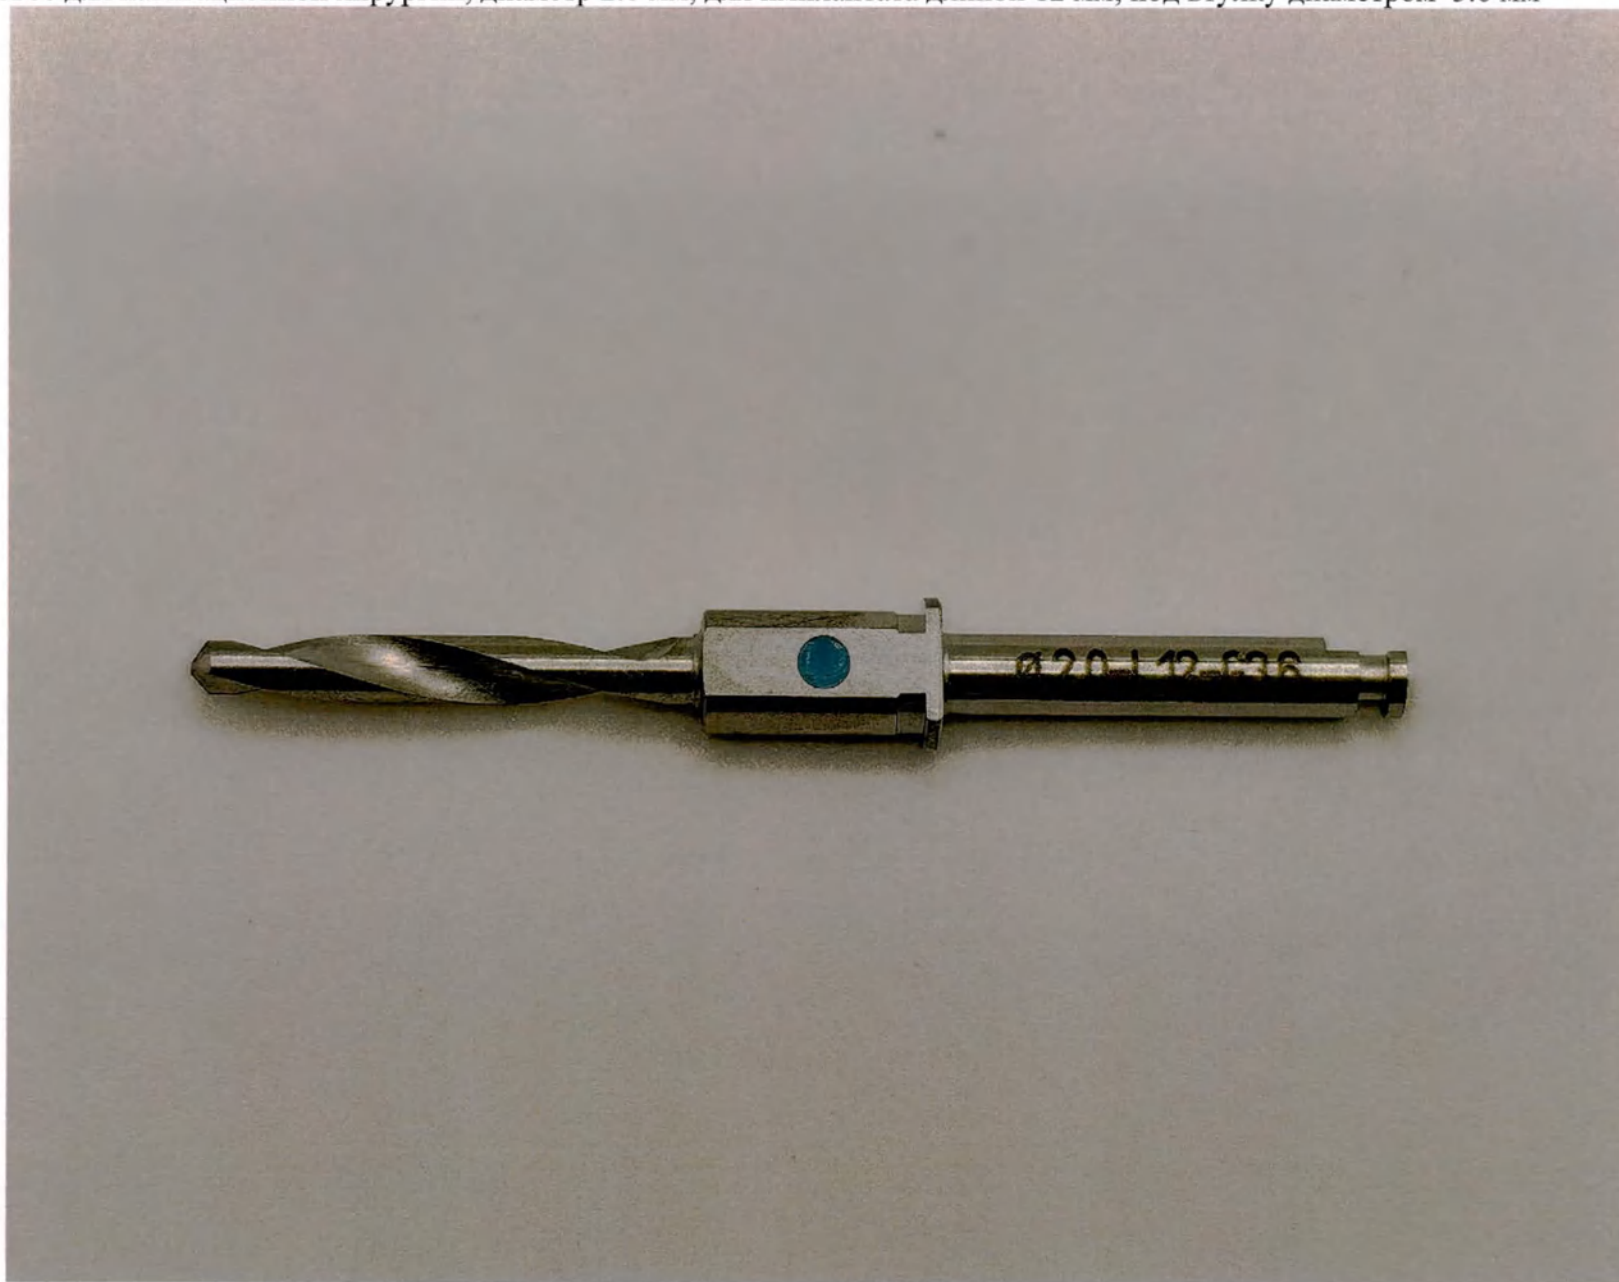


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм

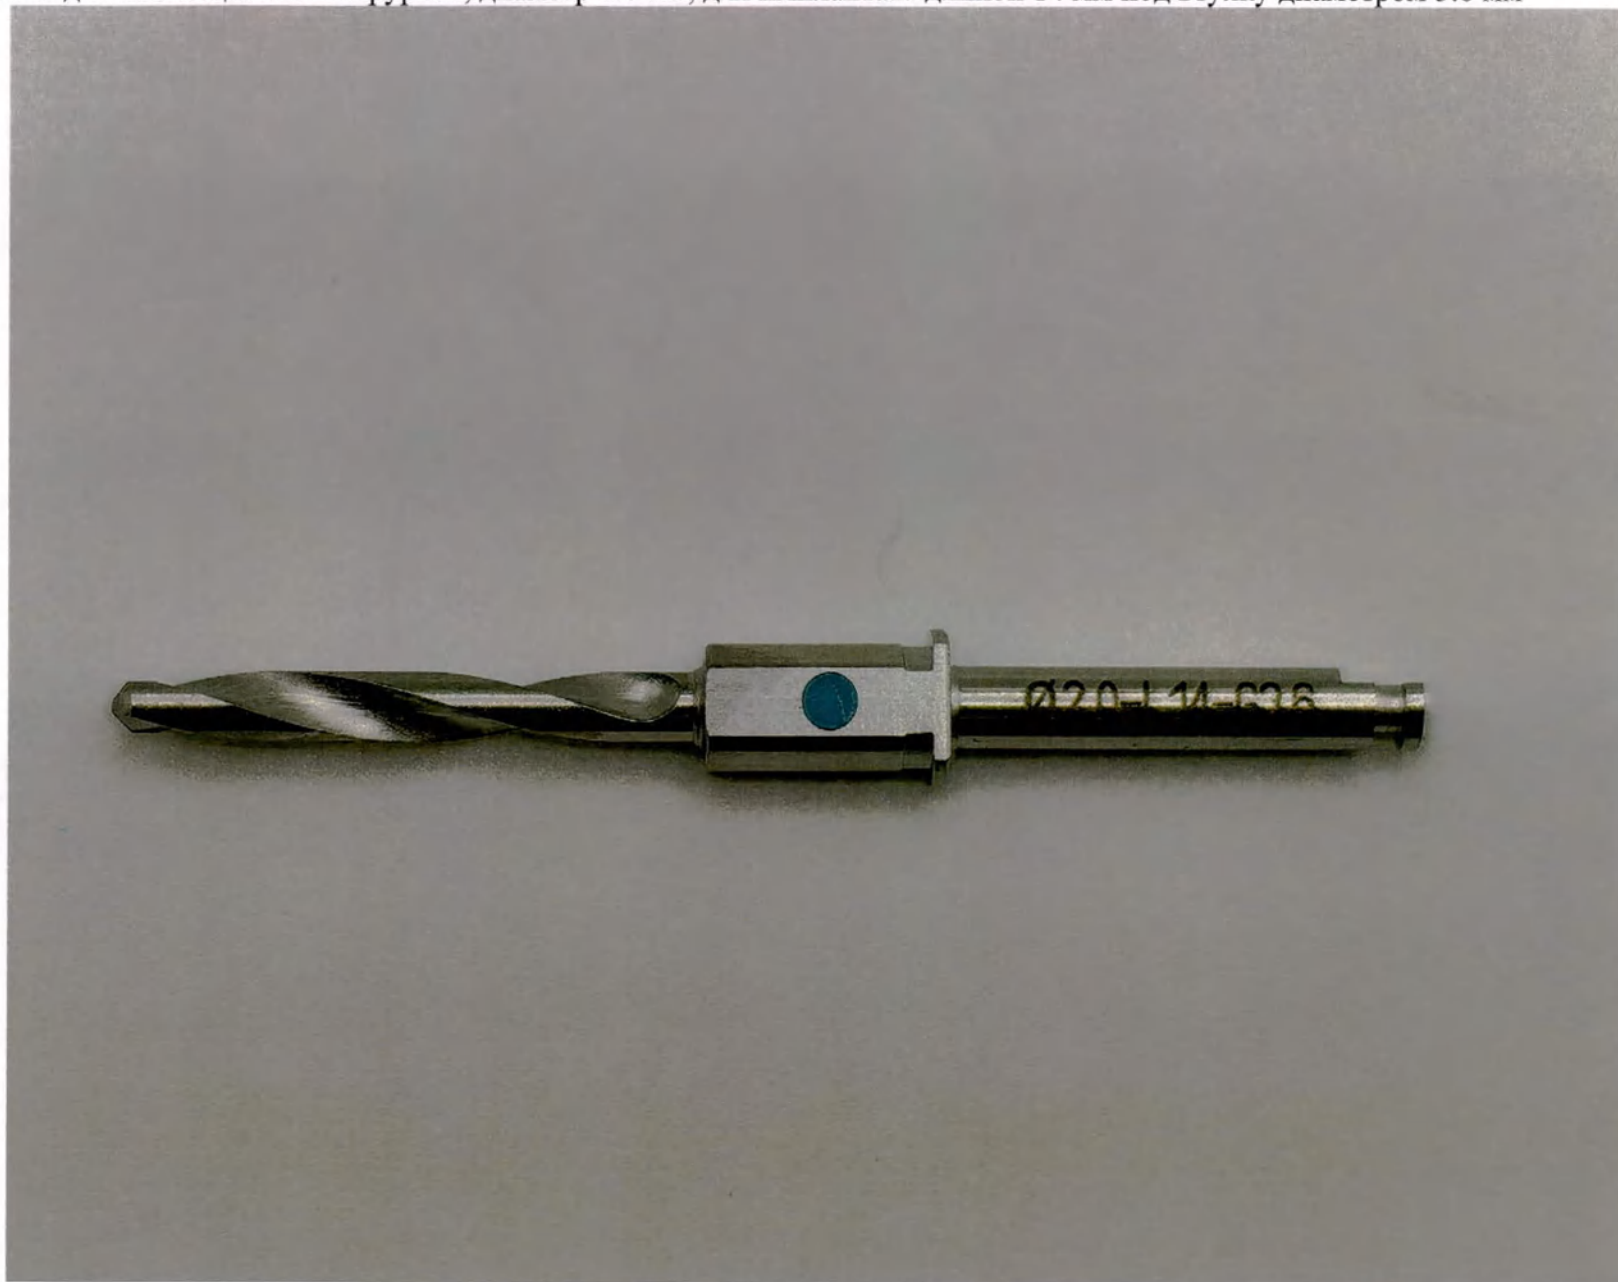


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

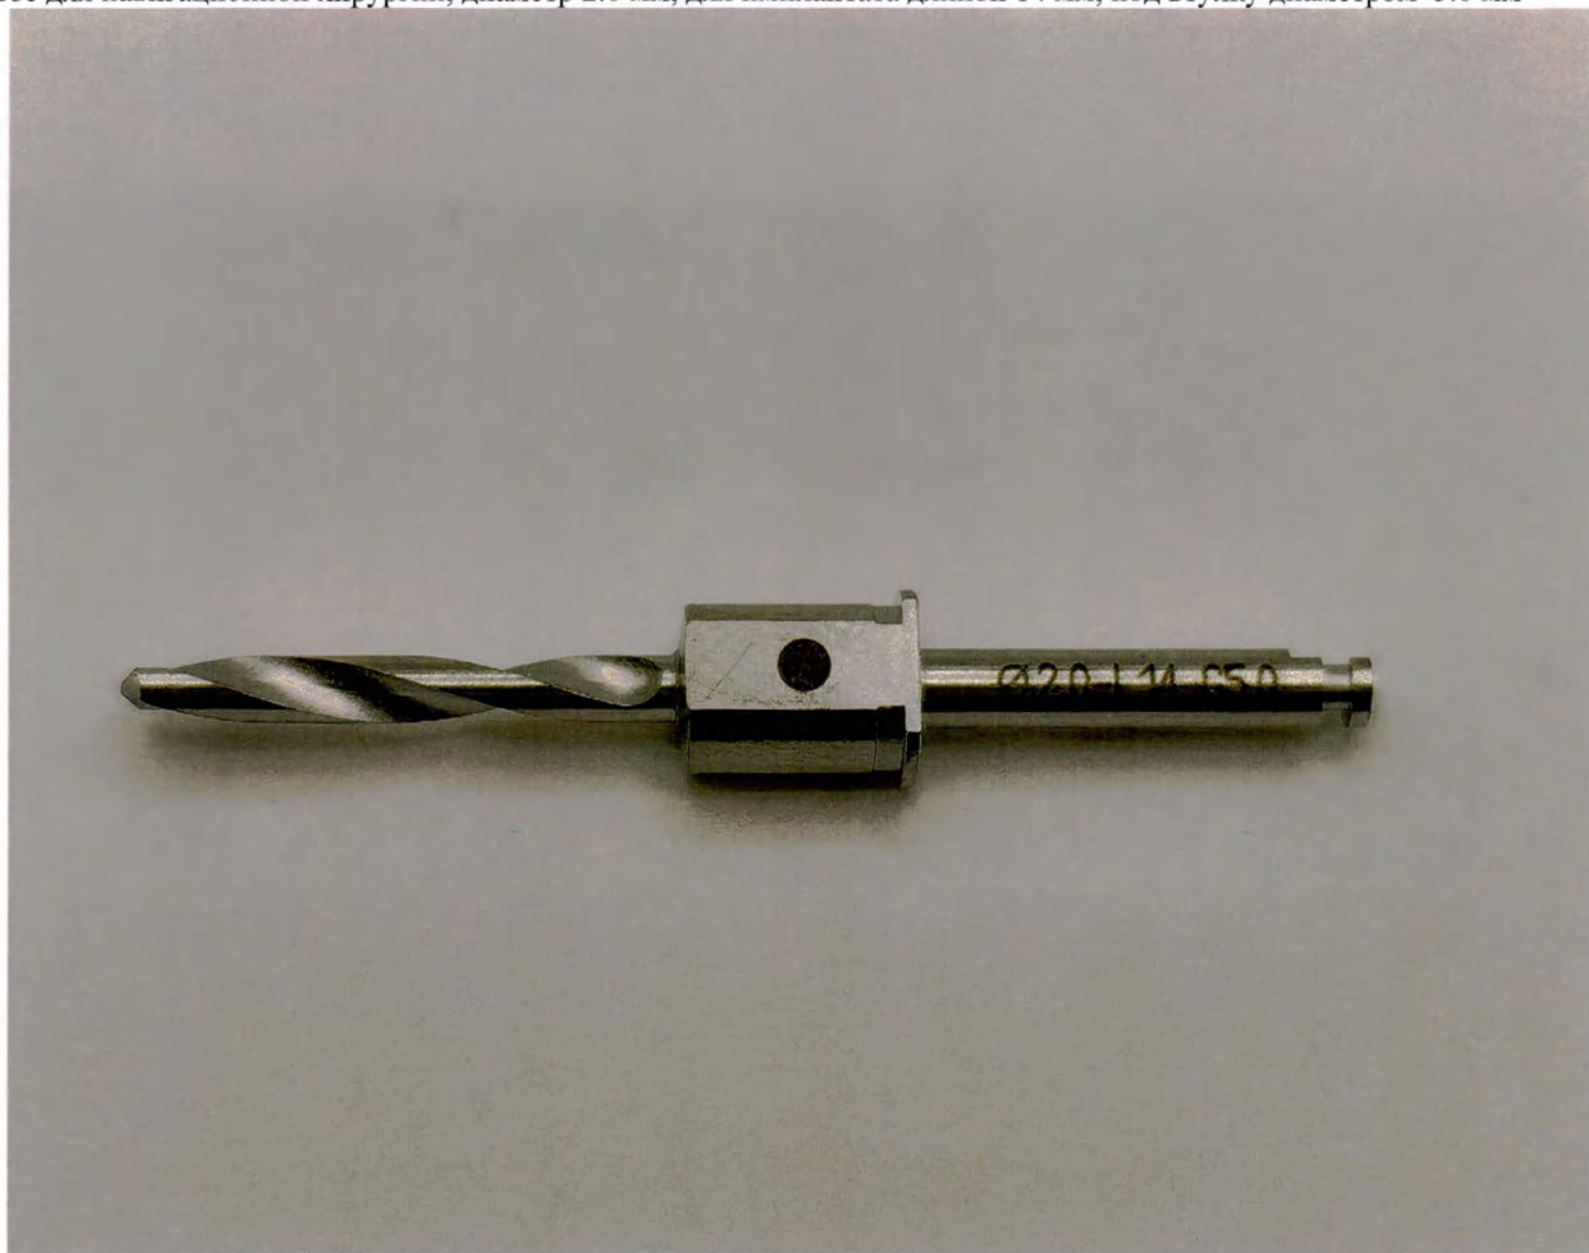


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

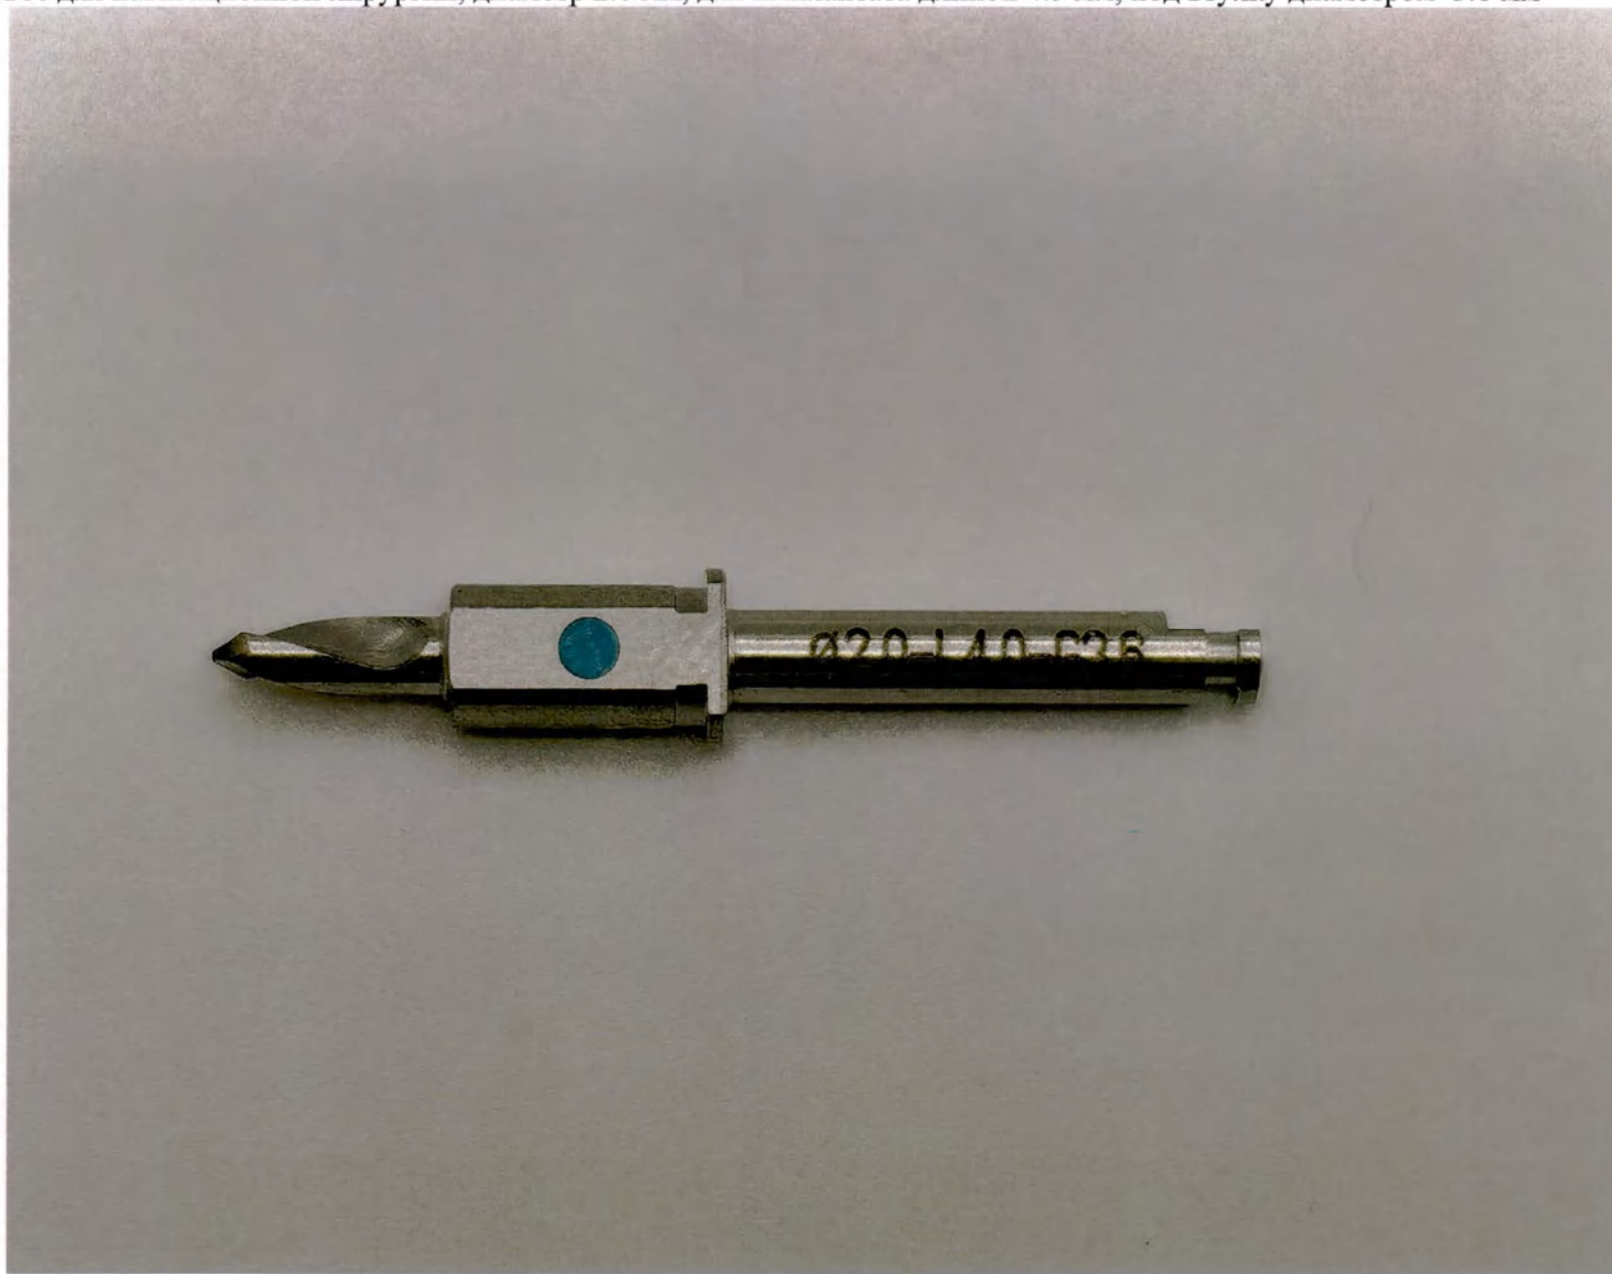

Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм

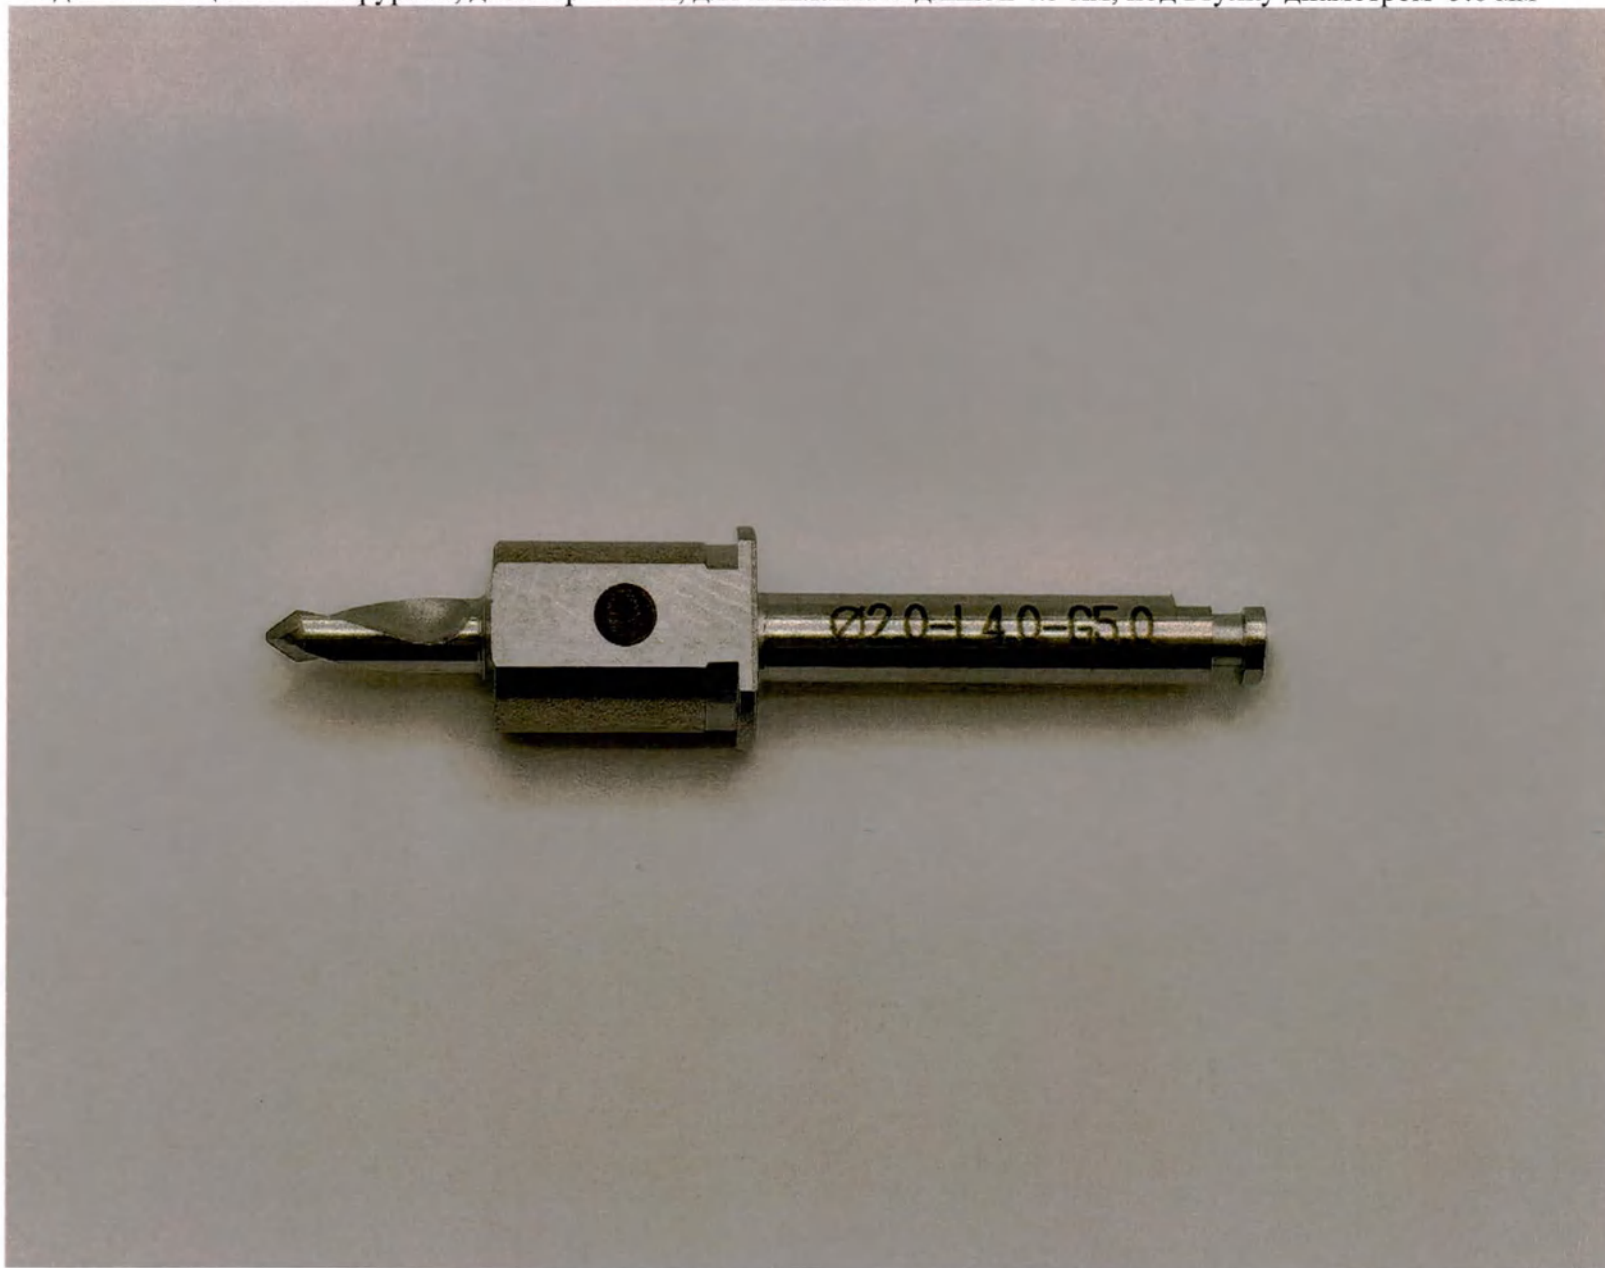

Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм

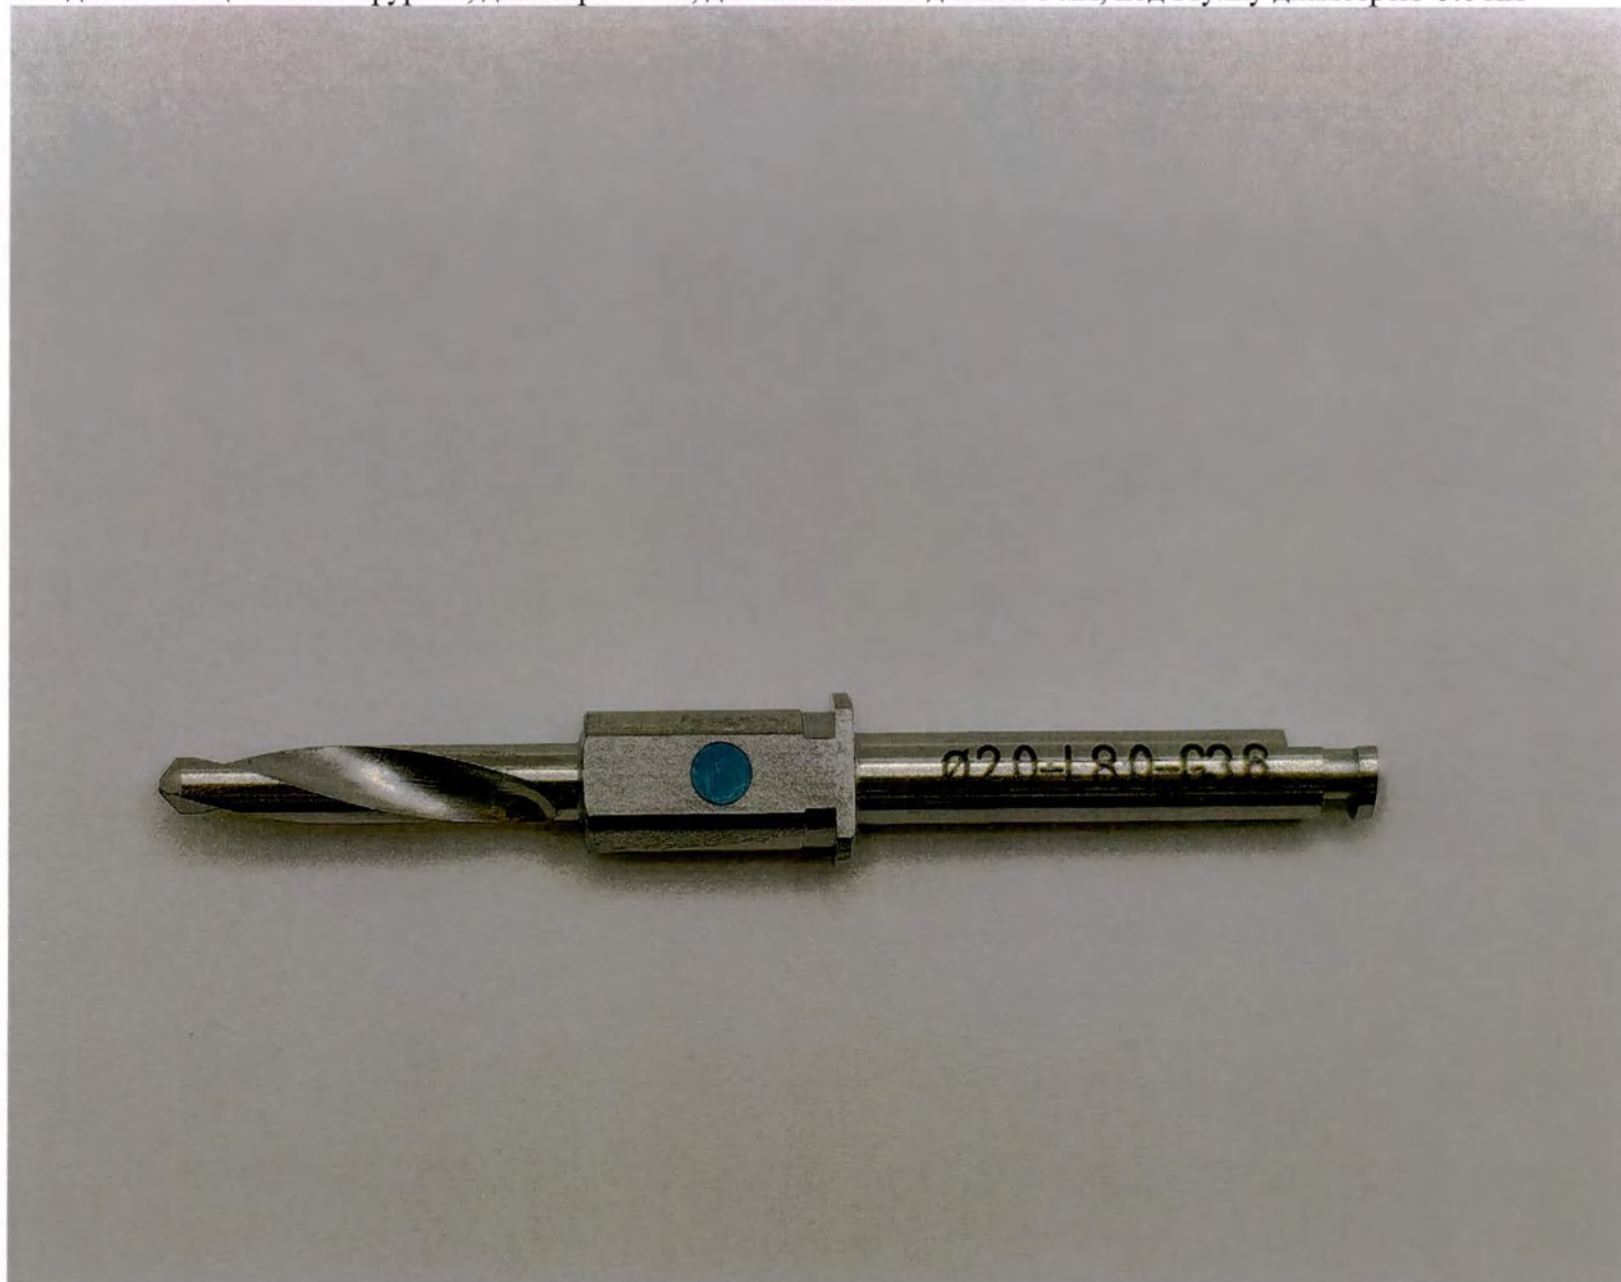


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм

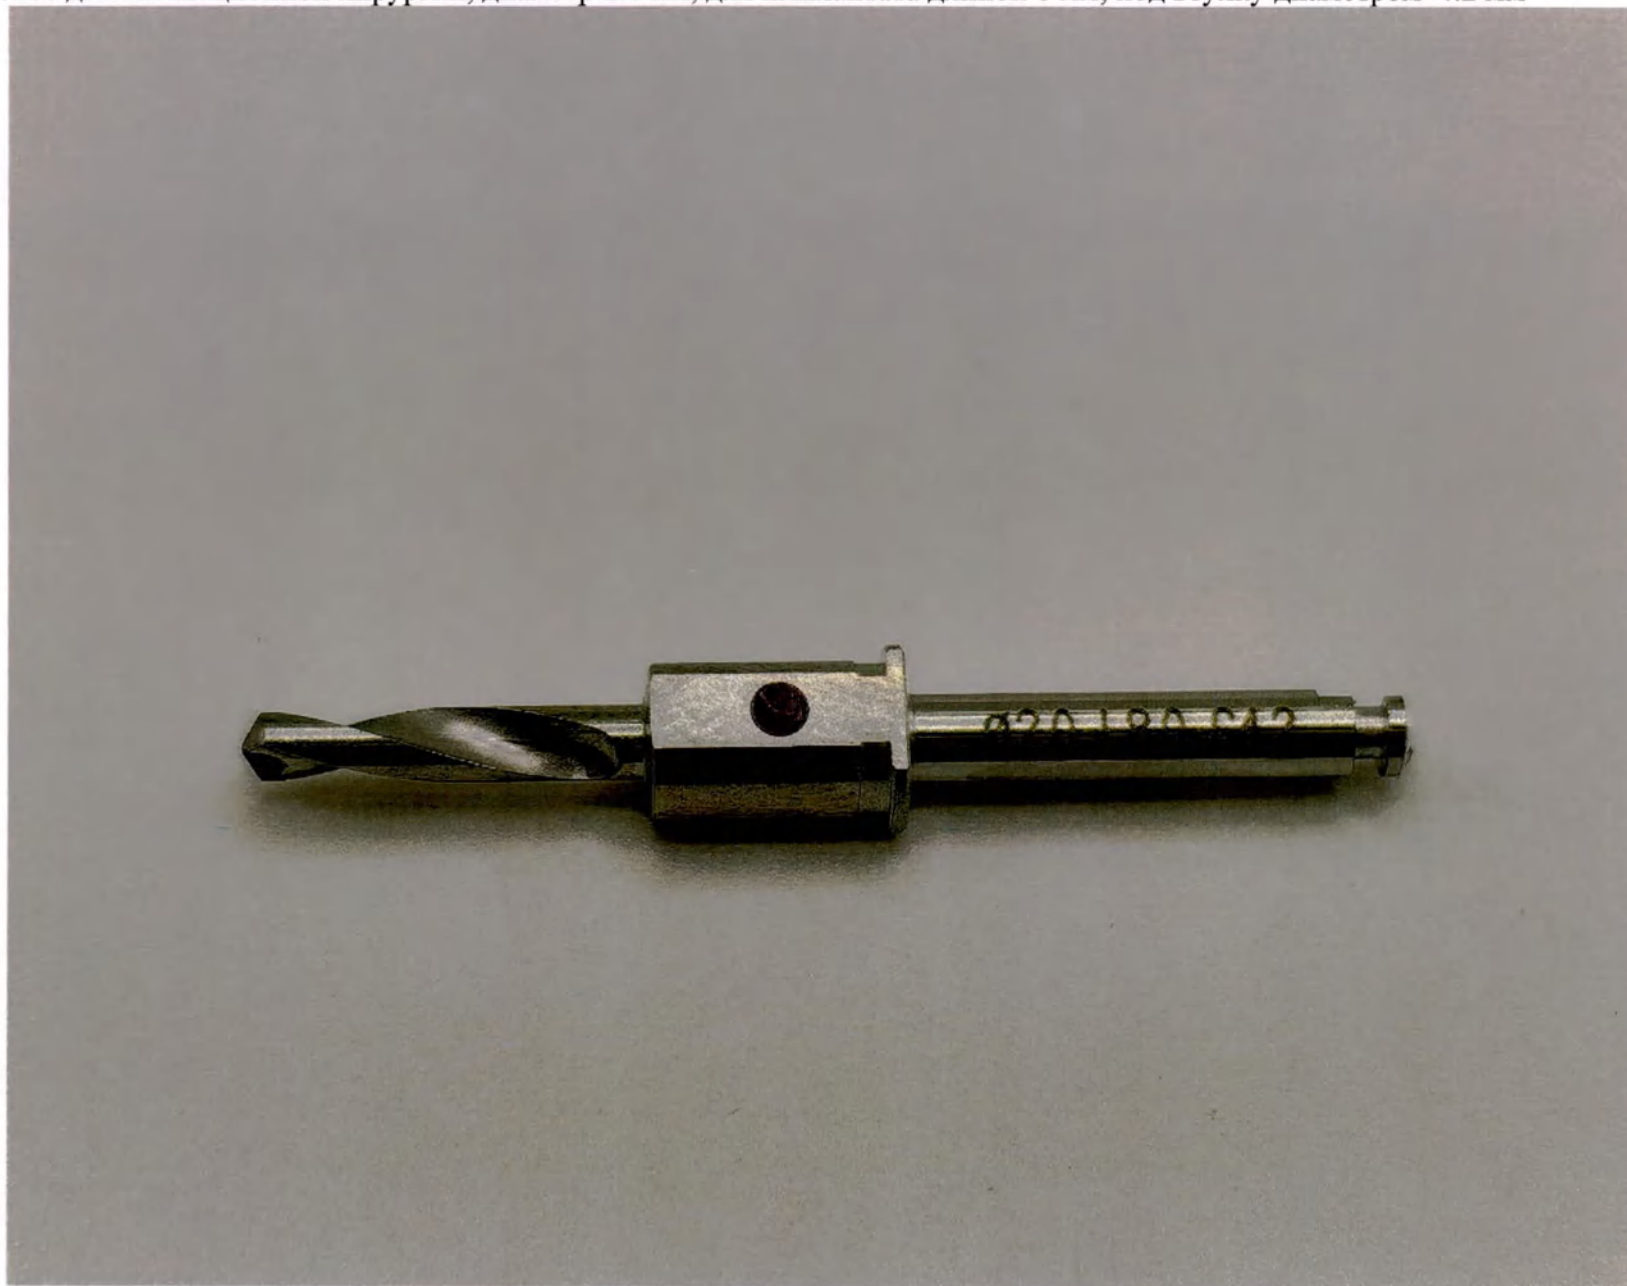


Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм

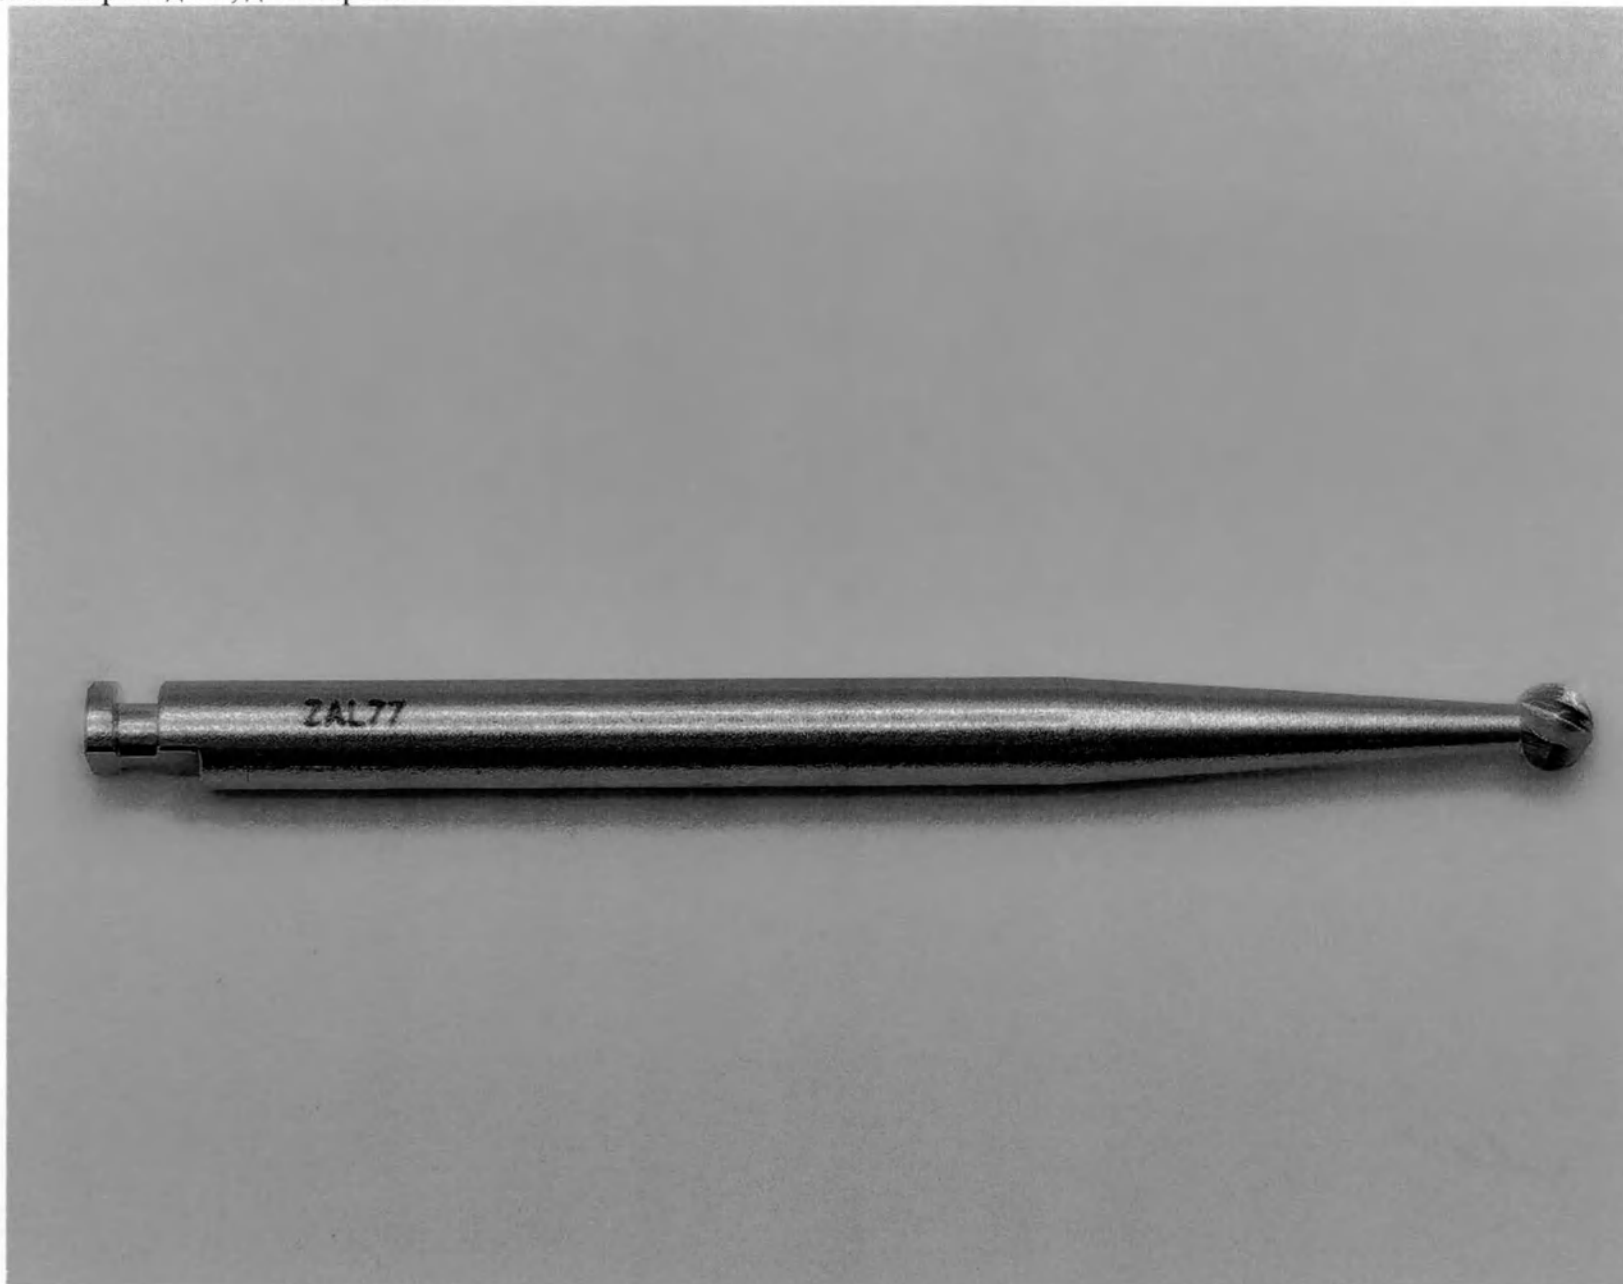

Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм

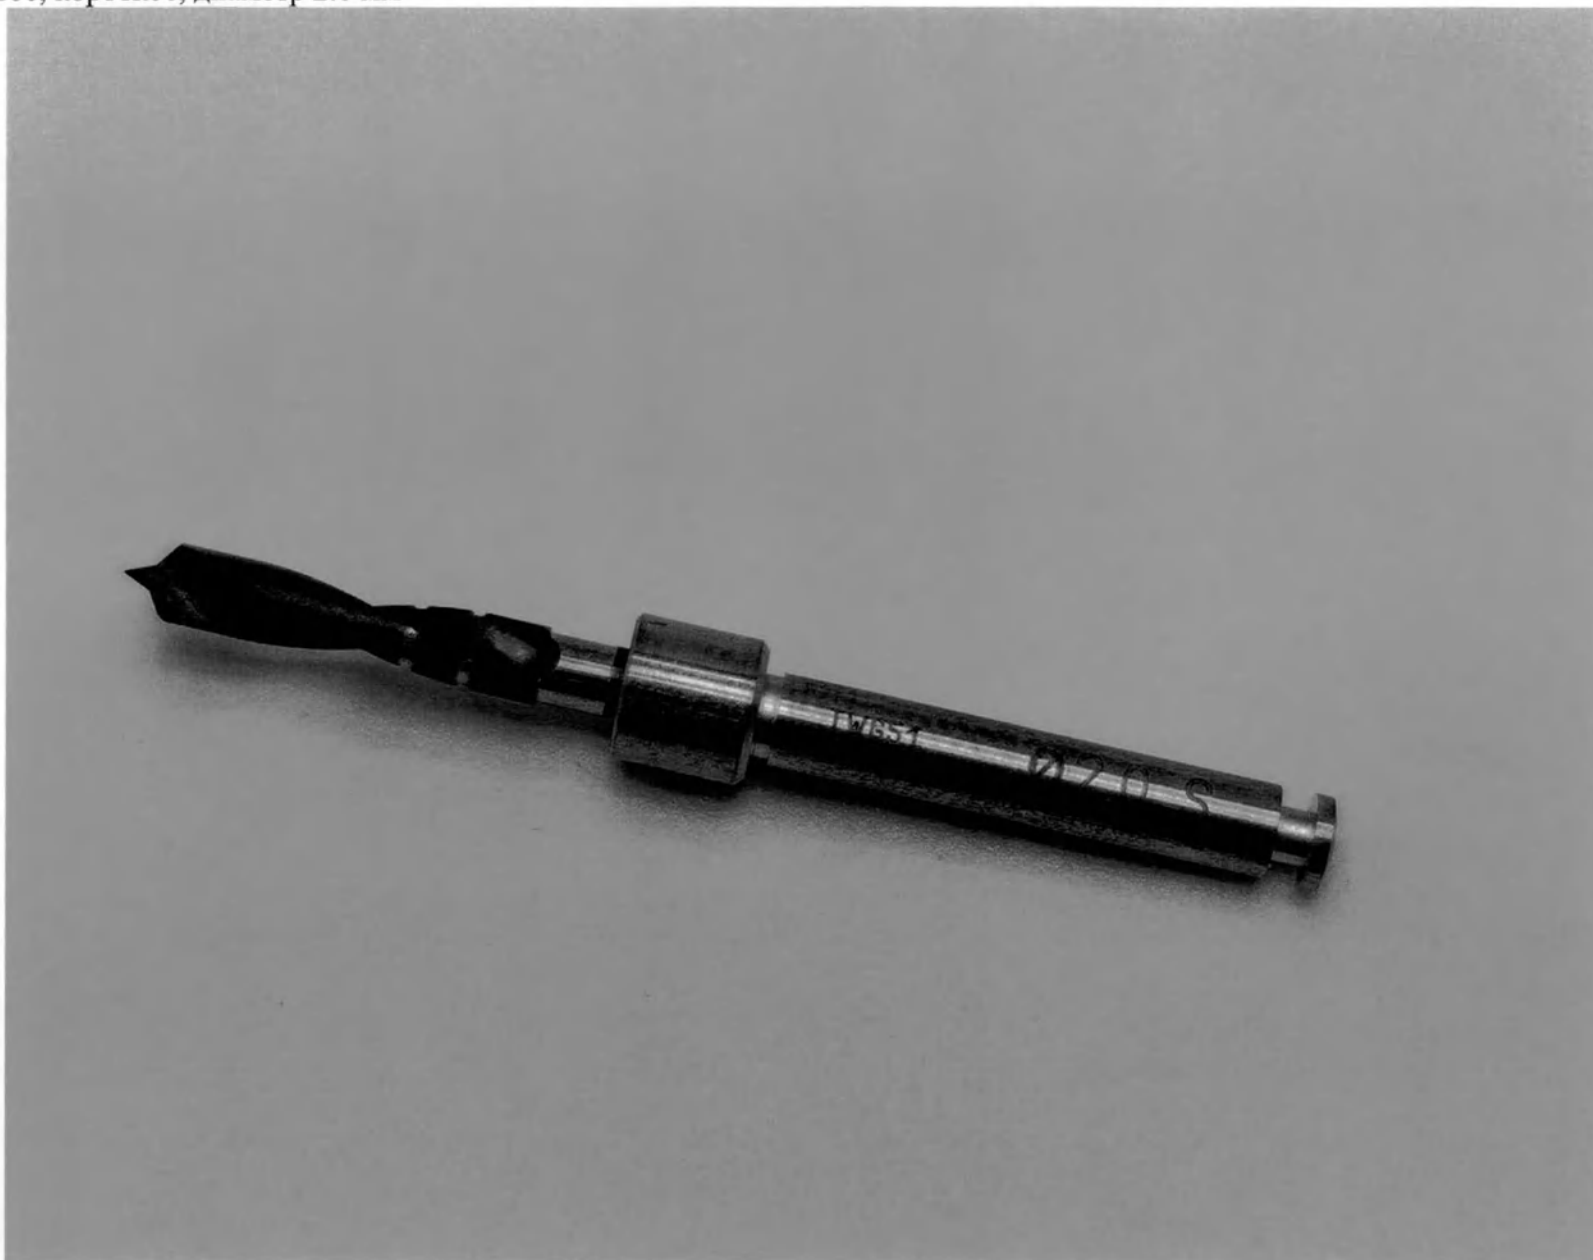

Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм




Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм

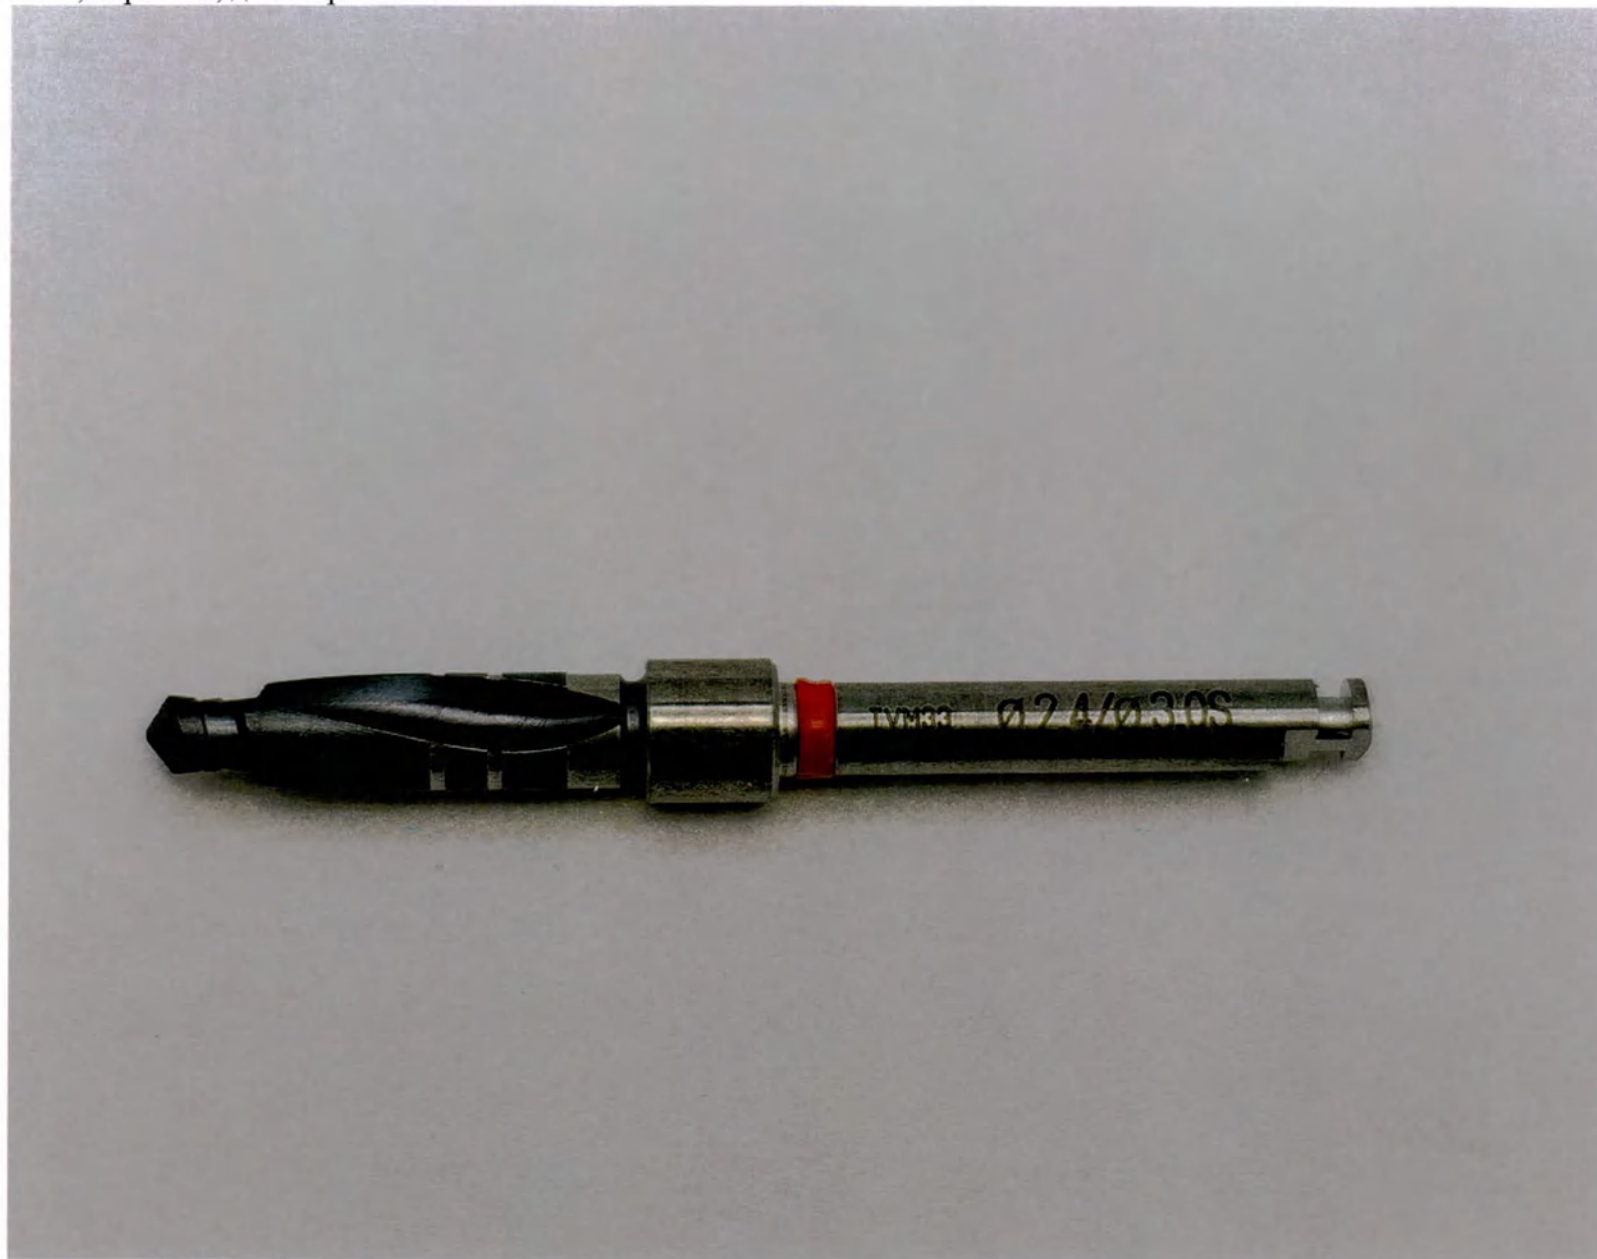

Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 3.0/3.2 мм



Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.6/3.8 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 4.2/4.4 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 4.8/5.0 мм



Сверло ступенчатое РХ, длинное, диаметр 3.4 мм



Сверло ступенчатое РХ, длинное, диаметр 4.0 мм



Сверло ступенчатое РХ, длинное, диаметр 4.6 мм



Сверло ступенчатое РХ, длинное, диаметр 5.2 мм



Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм с направляющей



Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм с направляющей



Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм с направляющей




Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм, с ограничителем




Кольцо центрирующее, диаметр 8 мм



Кольцо центрирующее, диаметр 10 мм

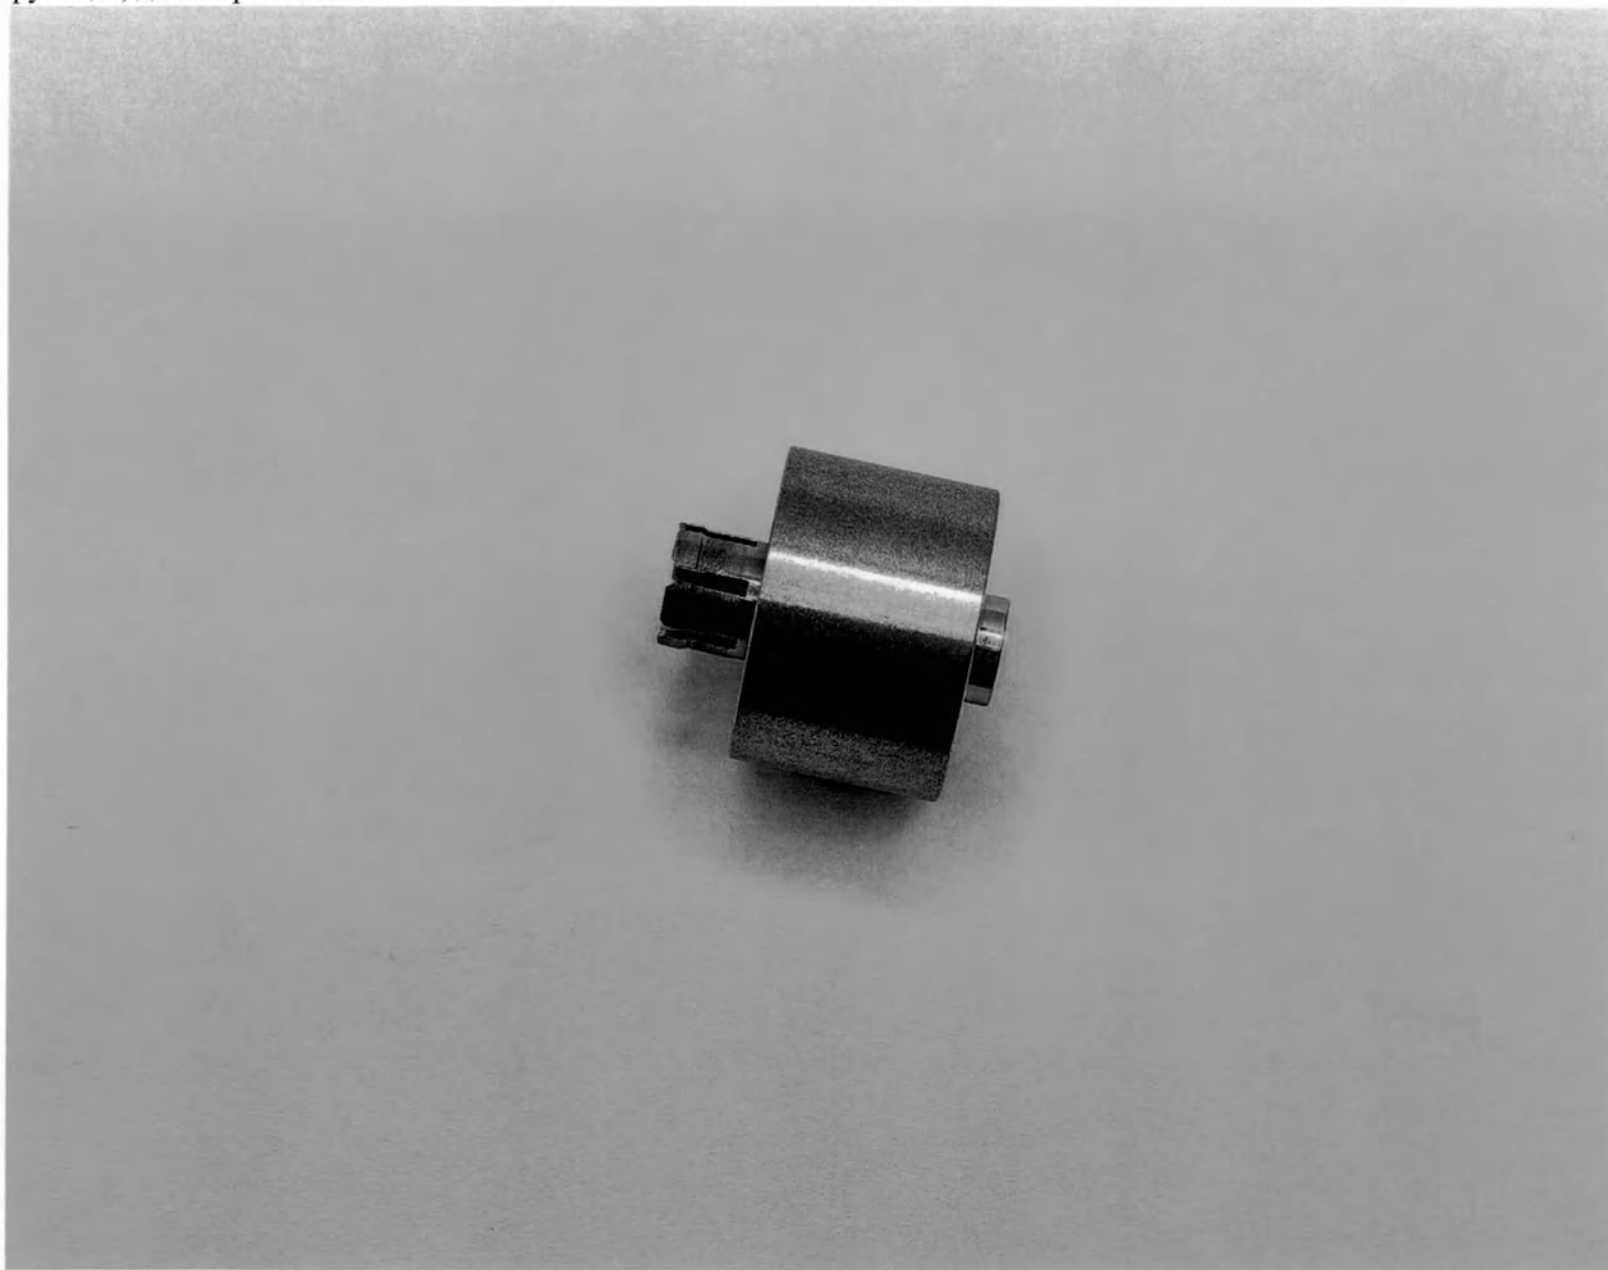


Потребительская упаковка (на примере сверла стартового шаровидного, диаметр 2.0 мм)

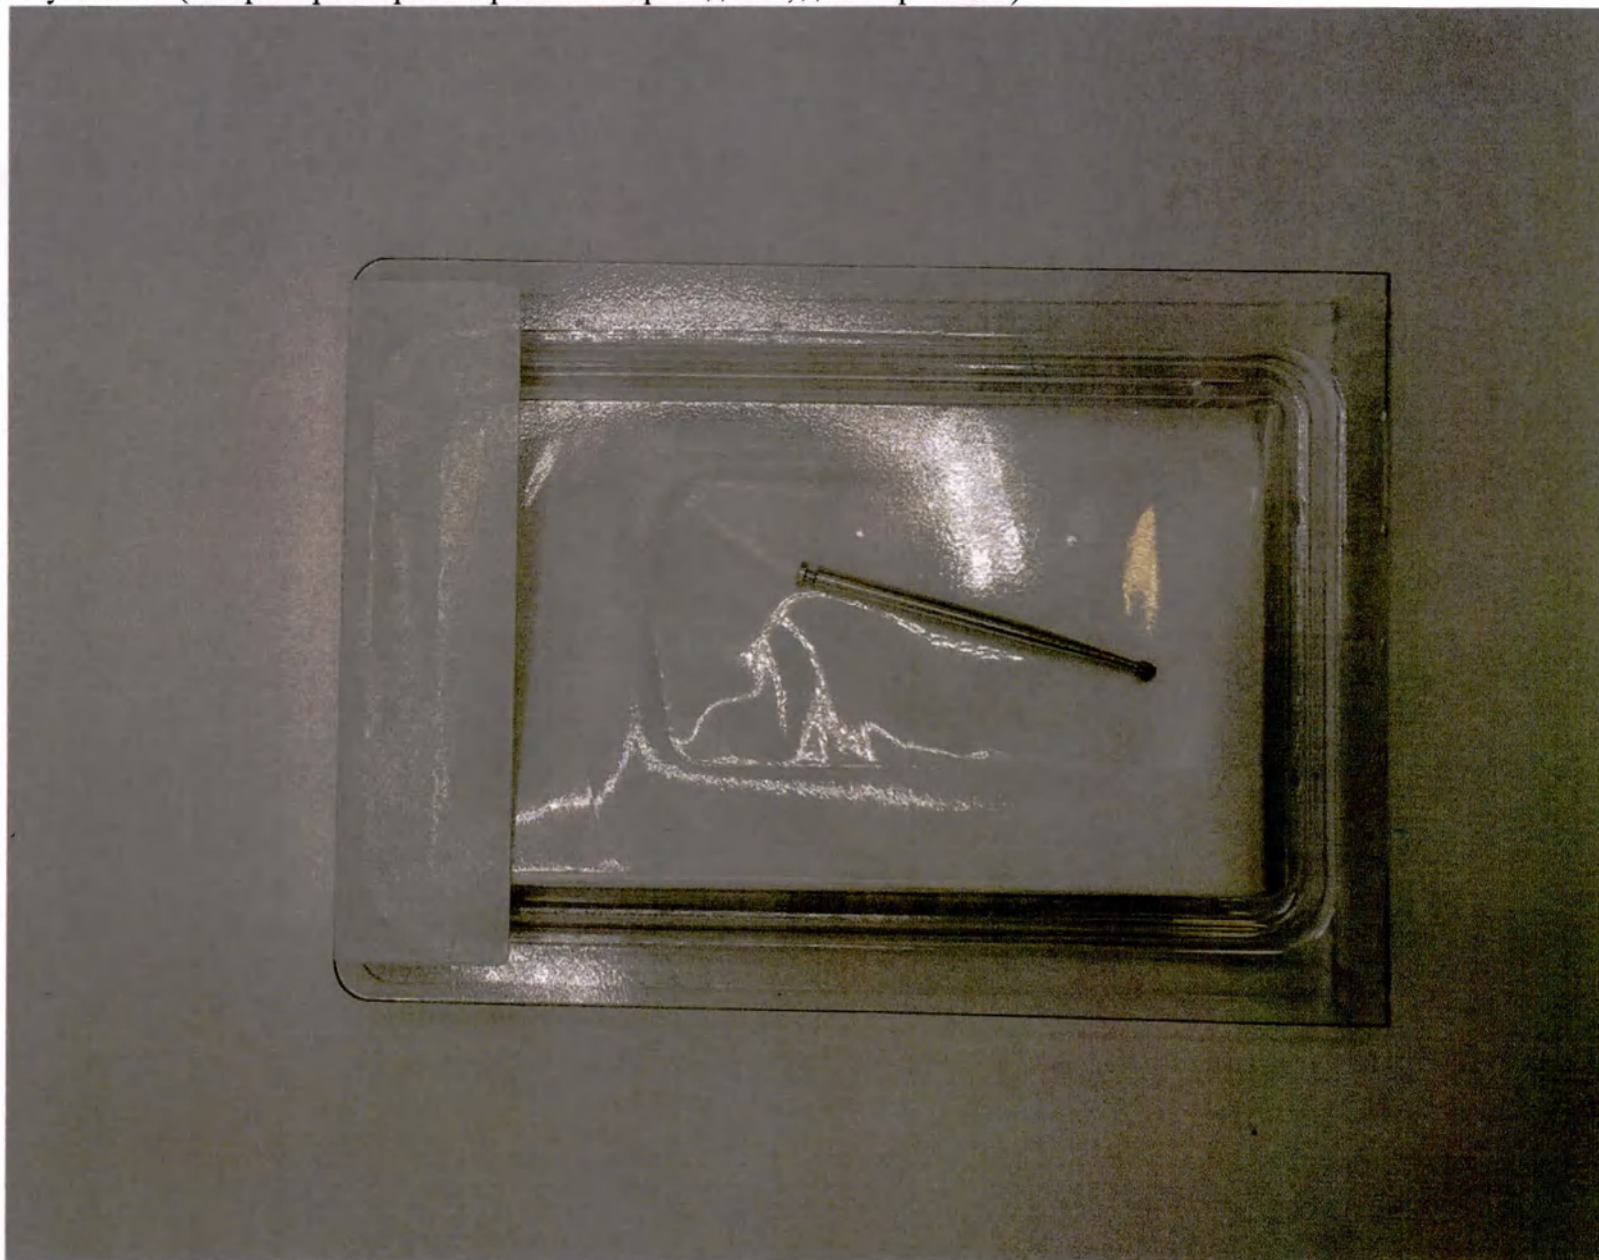

Маркировка на потребительской упаковке (на примере сверла стартового шаровидного, диаметр 2.0 мм)



Маркировка на потребительской упаковке (применимо только для вариантов исполнения «Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм с направляющей», «Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм с направляющей», «Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм с направляющей»)

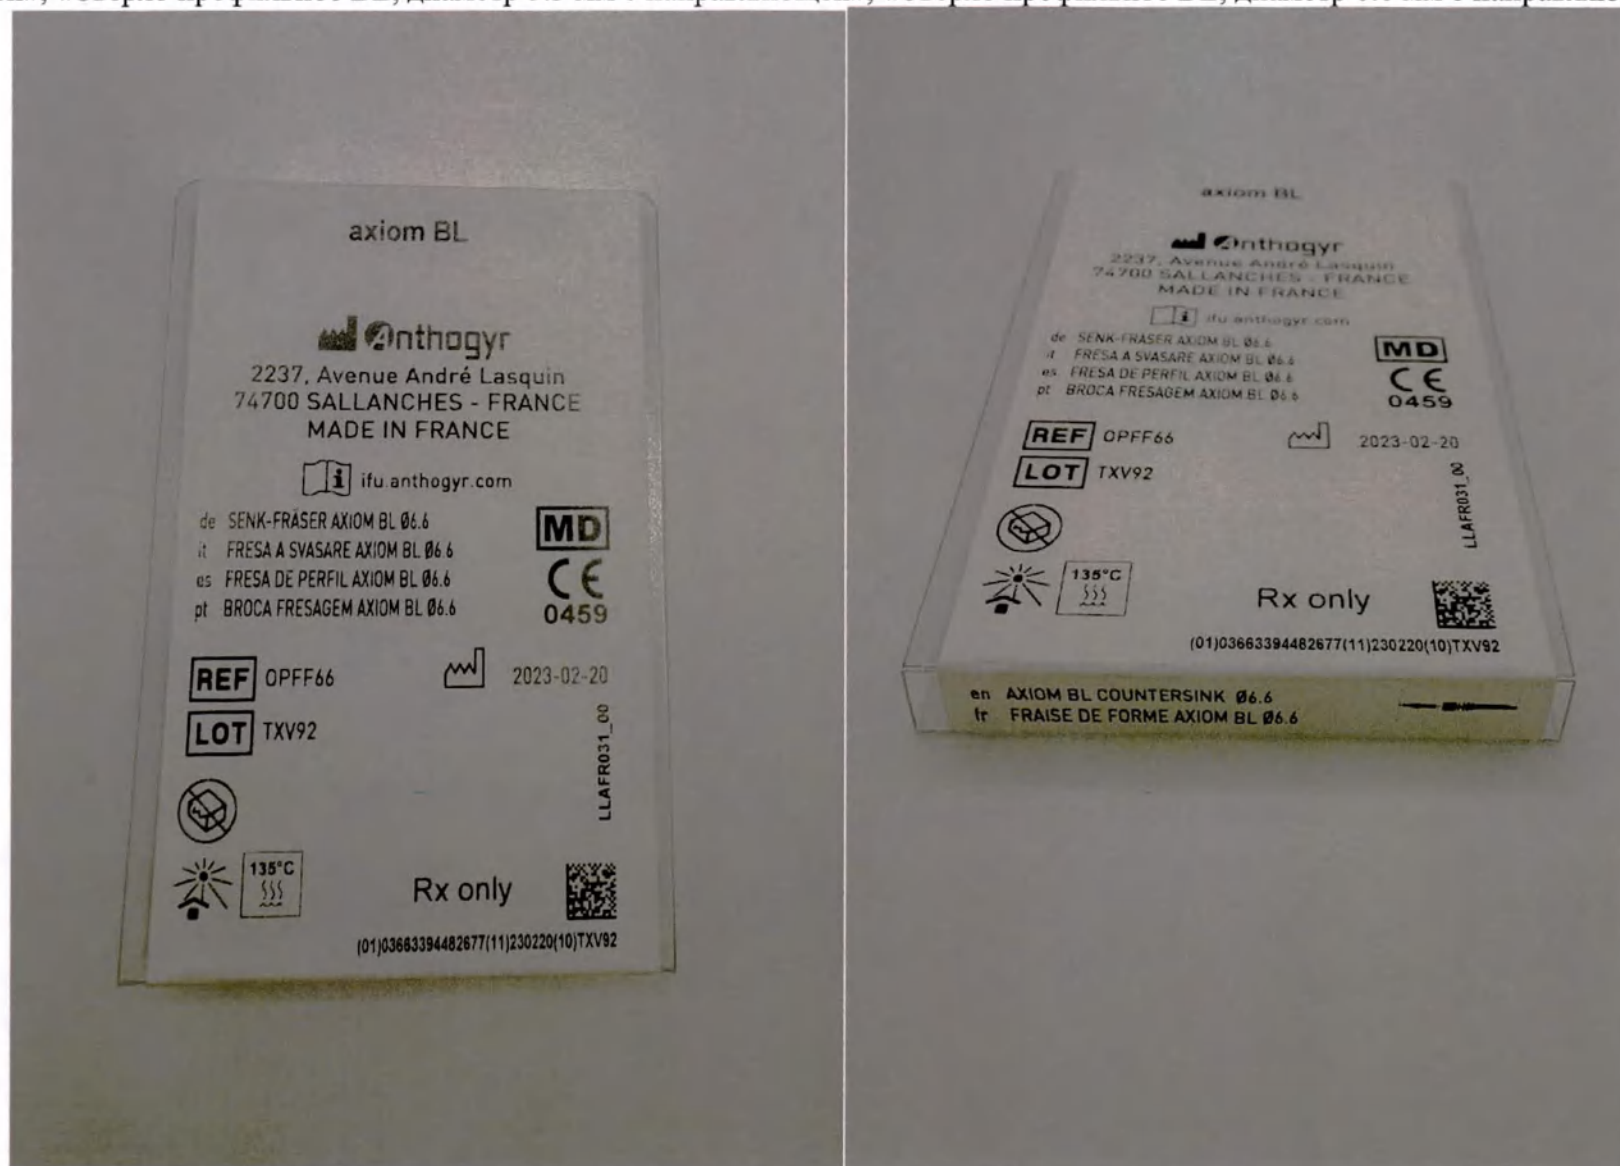

Пример макета русскоязычного стикера для сверл стоматологических:


Артикул: XXXXXX  
**Сверло стоматологическое для установки имплантата  
ANTHOGYR в вариантах исполнения с принадлежностями**  
Сверло 2.8, диаметр 2.6 мм

РУ №: ##### от ##.##.####  
Материал: нержавеющая сталь (Н)

 [straumann.ru/IFU](http://straumann.ru/IFU)

Изготовитель: ANTHOGYR SAS («Антожир САС»),  
2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France  
(Франция)  
Импортер: ООО «Штрауманн», Российская  
Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект,  
д. 119А  
Номер партии: XXXXXX  
Дата производства: XXXX-XX  
Срок годности: не ограничен

  
XXXXXX



Пример русскоязычного стикера для принадлежностей:

Артикул: XXXXXX  
**Сверло стоматологическое для установки имплантата  
ANTHOGYR в вариантах исполнения с принадлежностями**  
Кольцо центрирующее, диаметр 8 мм

РУ №: ##### от ##.##.####  
Материал: титан (Ti)

 [straumann.ru/IFU](http://straumann.ru/IFU)

Изготовитель: ANTHOGRYR SAS («Антожир САС»),  
2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France  
(Франция)  
Импортер: ООО «Штрауманн», Российская  
Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект,  
д. 119А  
Номер партии: XXXXXX  
Дата производства: XXXX-XX  
Срок годности: не ограничен

  
XXXXX



Прошнуровано 125 листа/ов

Специалист по регистрации  
ООО «Штрауманн»



М.А.Гребенкина