

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации

ООО «Штрауманн»

М.А. Гребенкина

2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии

Фотографические изображения Втулки шаблонной Anthogyr для навигационной хирургии, для пина, диаметр 2.0 мм:


1. Общий вид Втулки шаблонной Anthogyr для навигационной хирургии, для пина, диаметр 2.0 мм

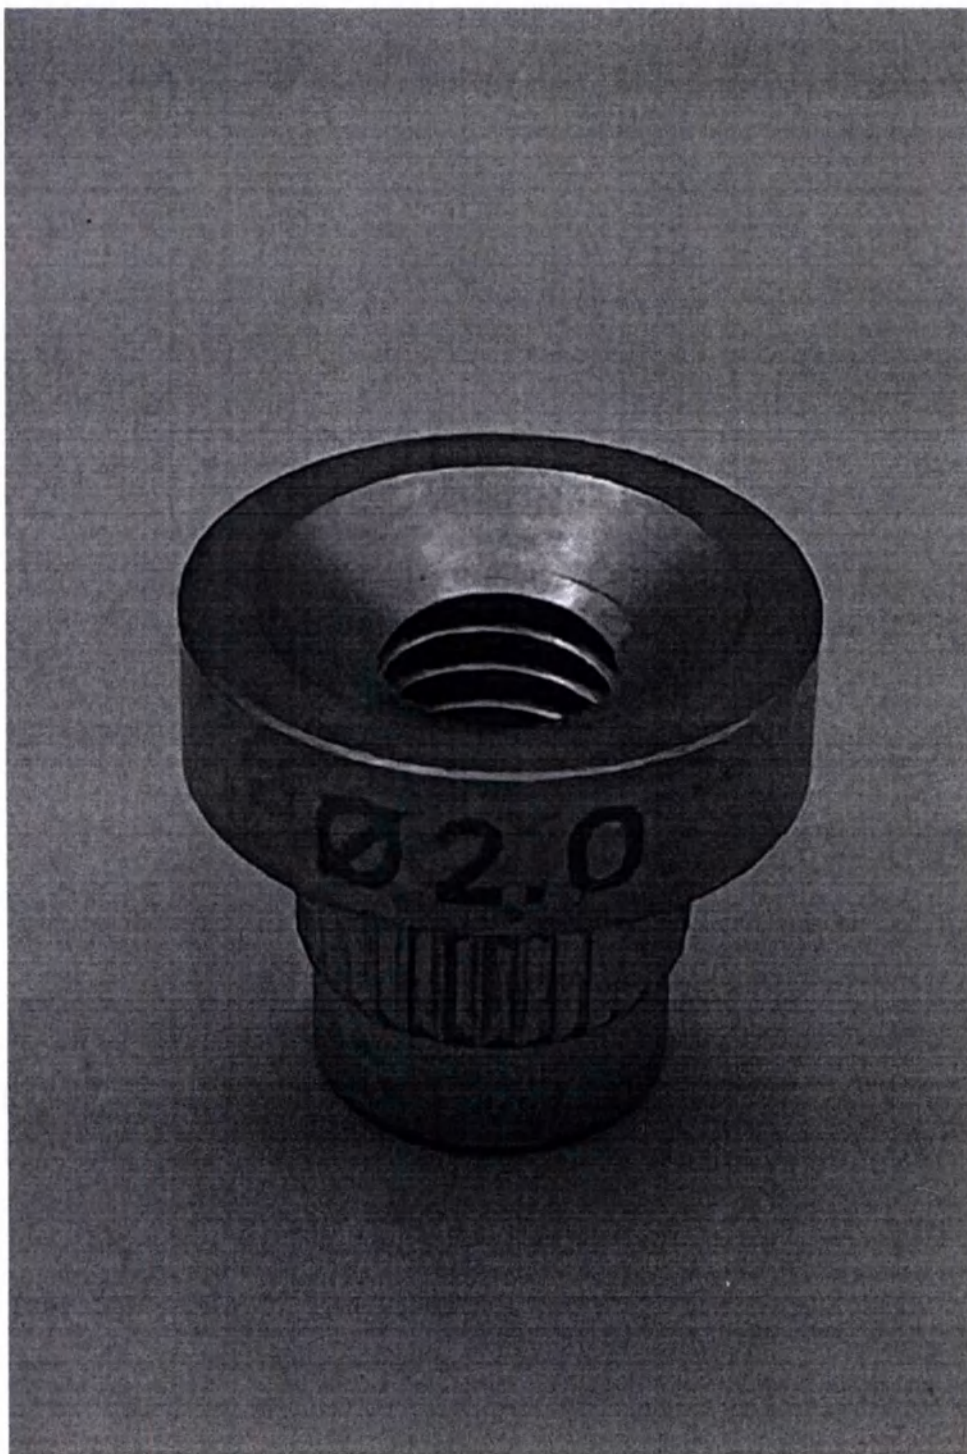


2. Первичная упаковка (пакет из тайвека) на примере варианта исполнения «Втулка
шаблонная Anthogug для навигационной хирургии, для пина, диаметр 2.0 мм (5
шт./уп.)»

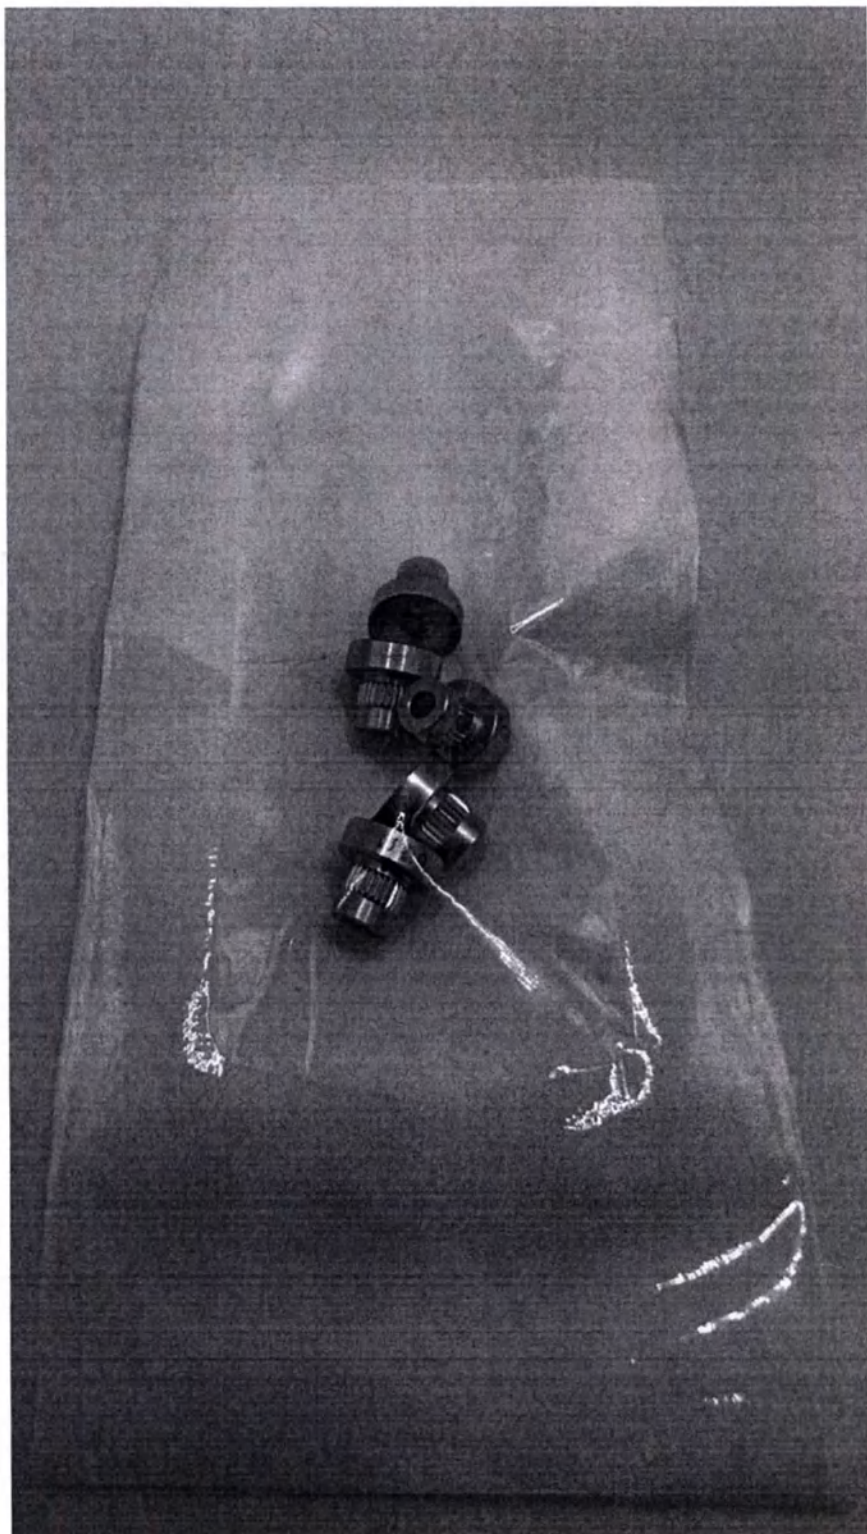

3. Вторичная упаковка (защитный блистер из ПЭТГ) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, для пина, диаметр 2.0 мм (5 шт./уп.)»

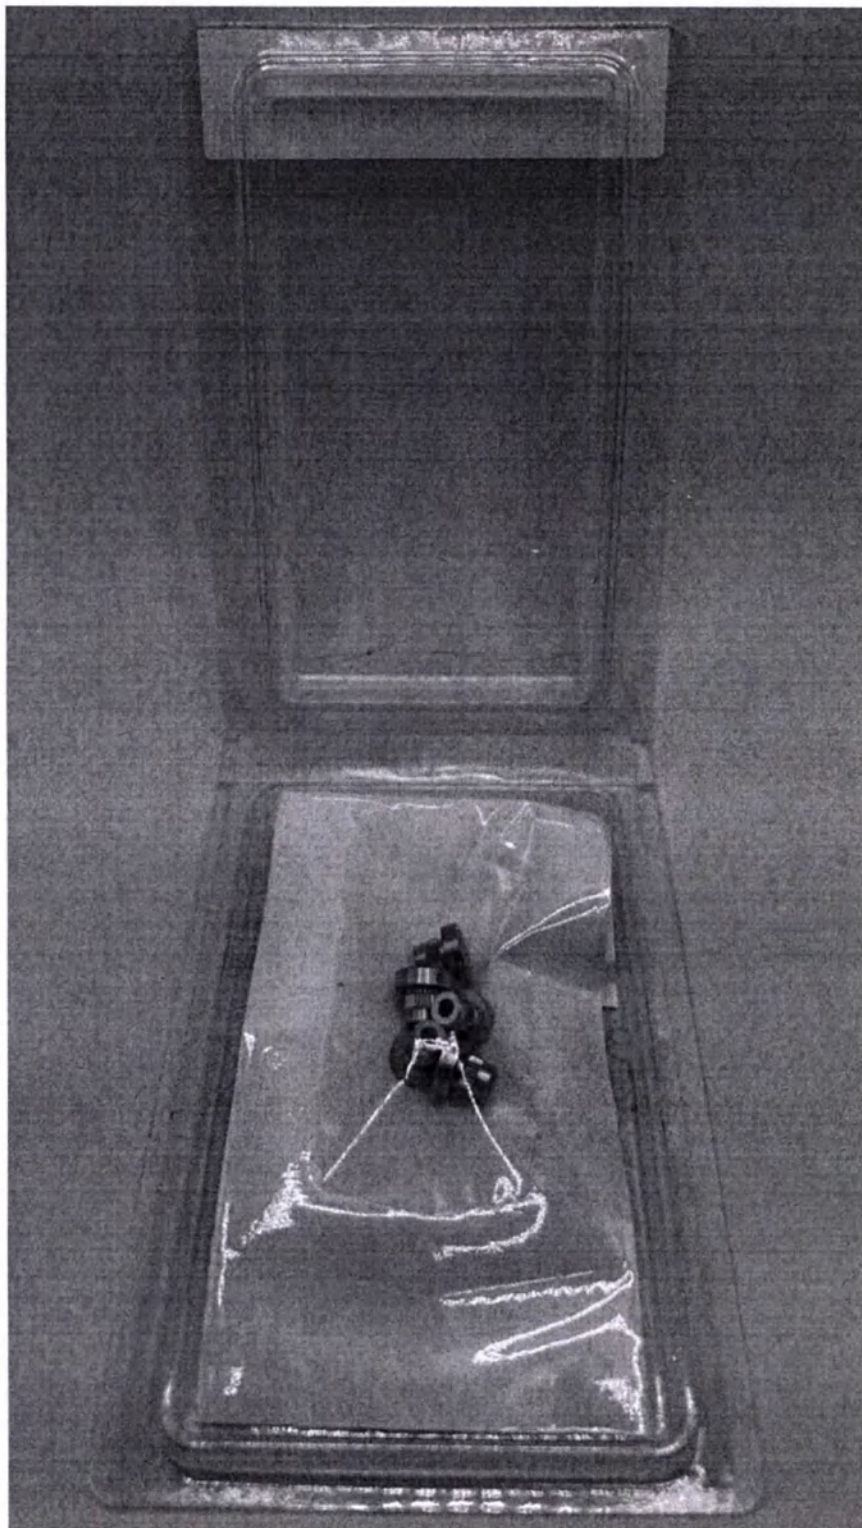

4. Пример маркировки для варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, для пина, диаметр 2.0 мм (5 шт./уп.)»

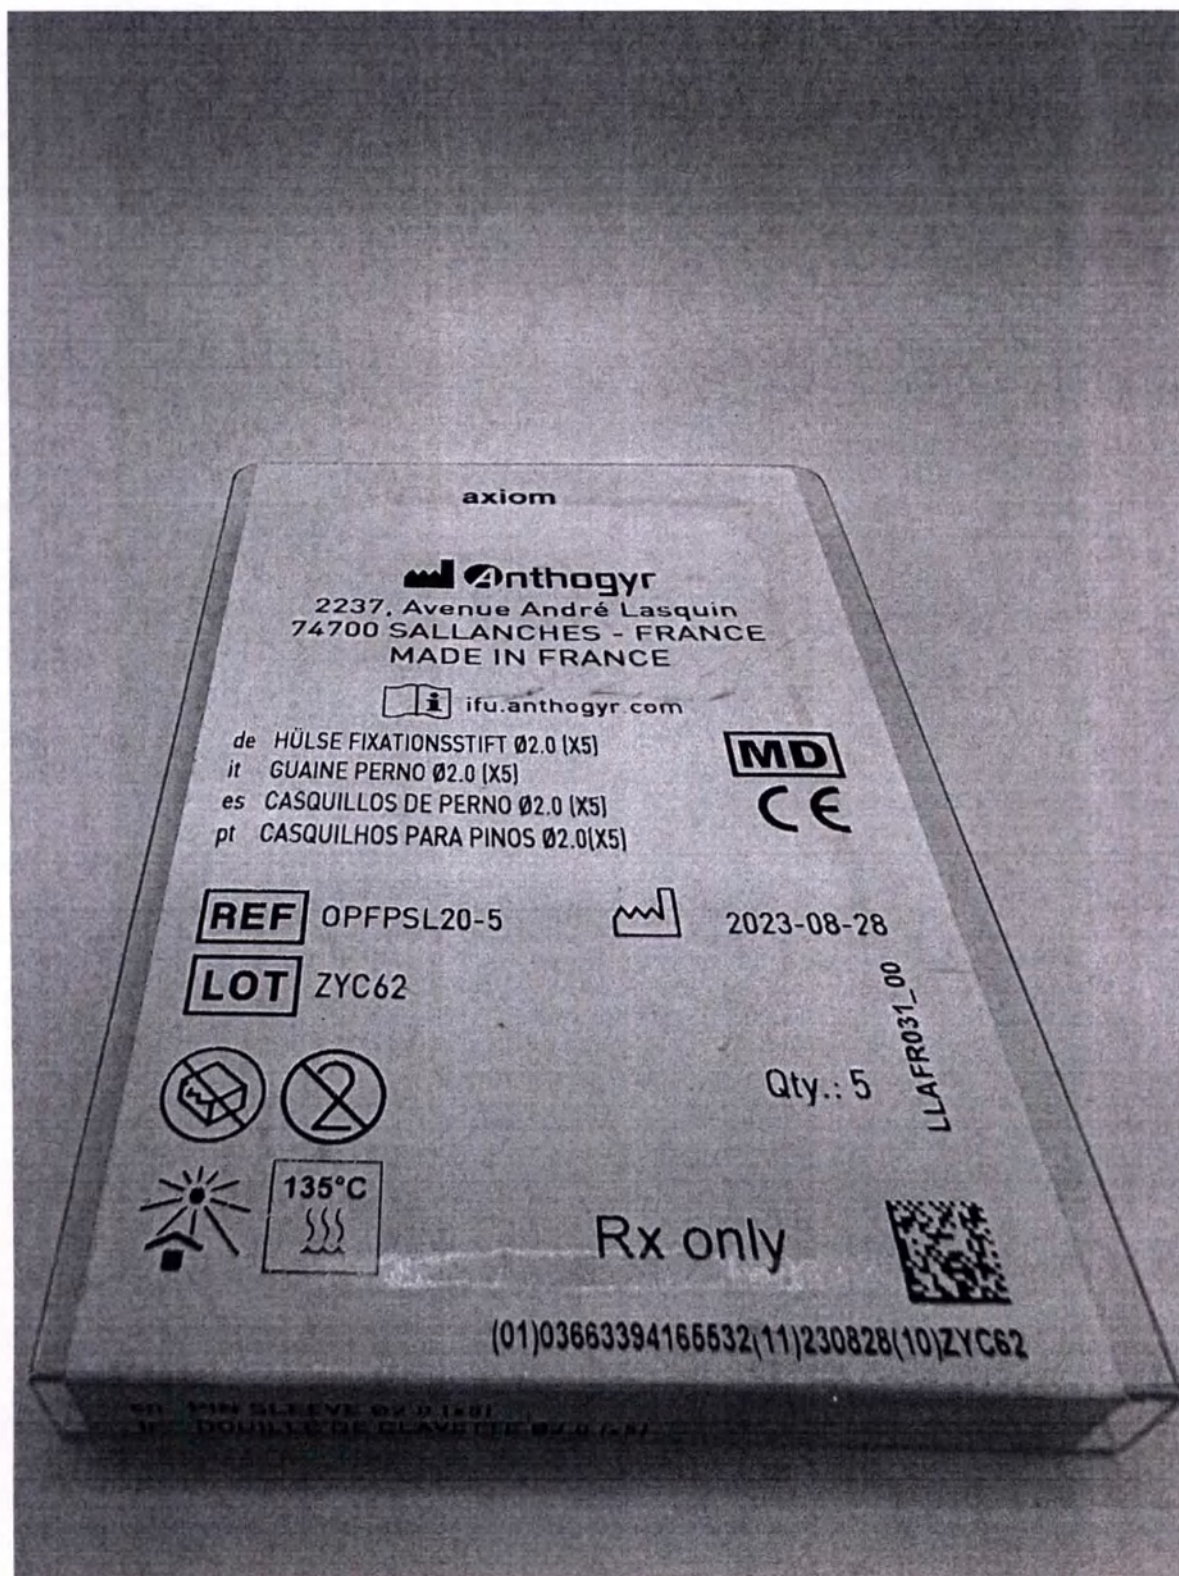


Фотографические изображения Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм:


1. Общий вид Втулки шаблонной Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп.)



2. Первичная упаковка (пакет из тайвека) на примере варианта исполнения «Втулка
шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп.)»

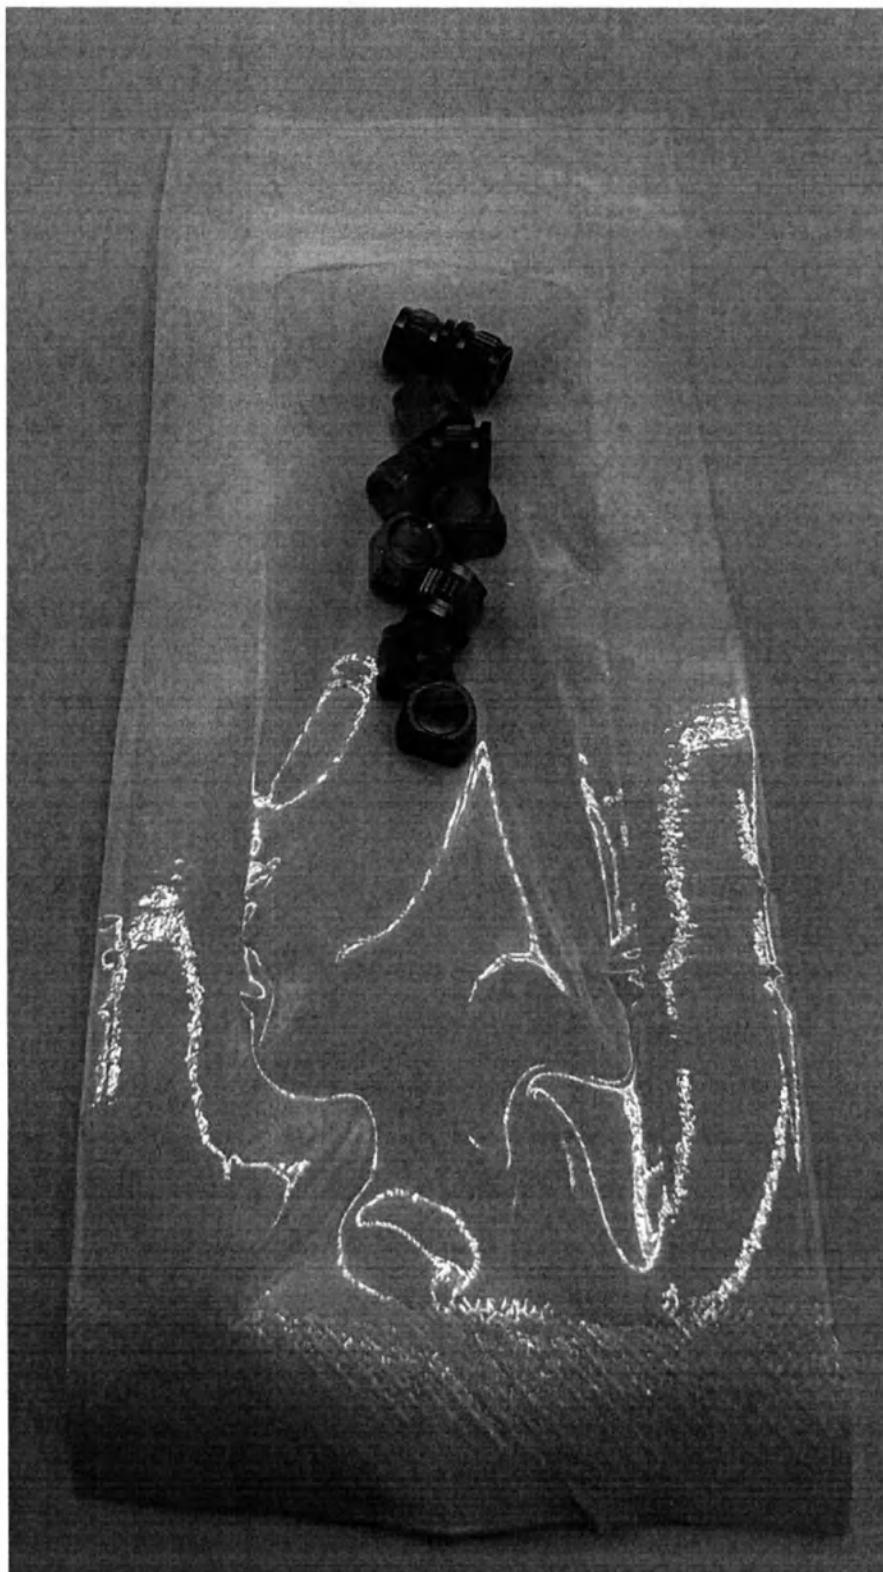

3. Вторичная упаковка (защитный блистер из ПЭТГ) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogug для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп.)»

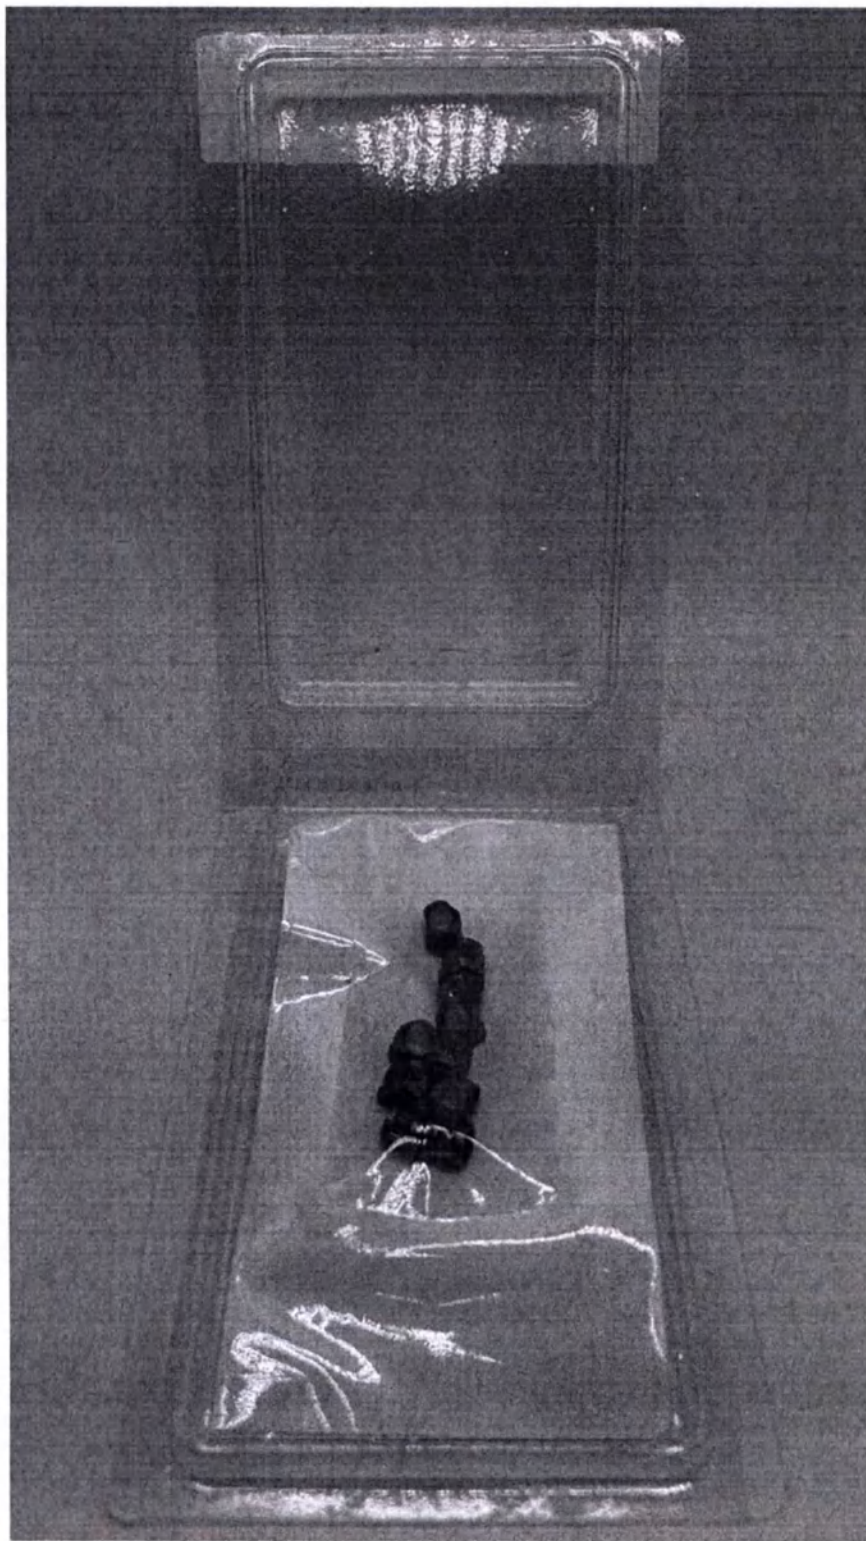


4. Пример маркировки для варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп.)»




Фотографические изображения Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 4.2 мм:


1. Общий вид Втулки шаблонной Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 4.2 мм (10 шт./уп.)»

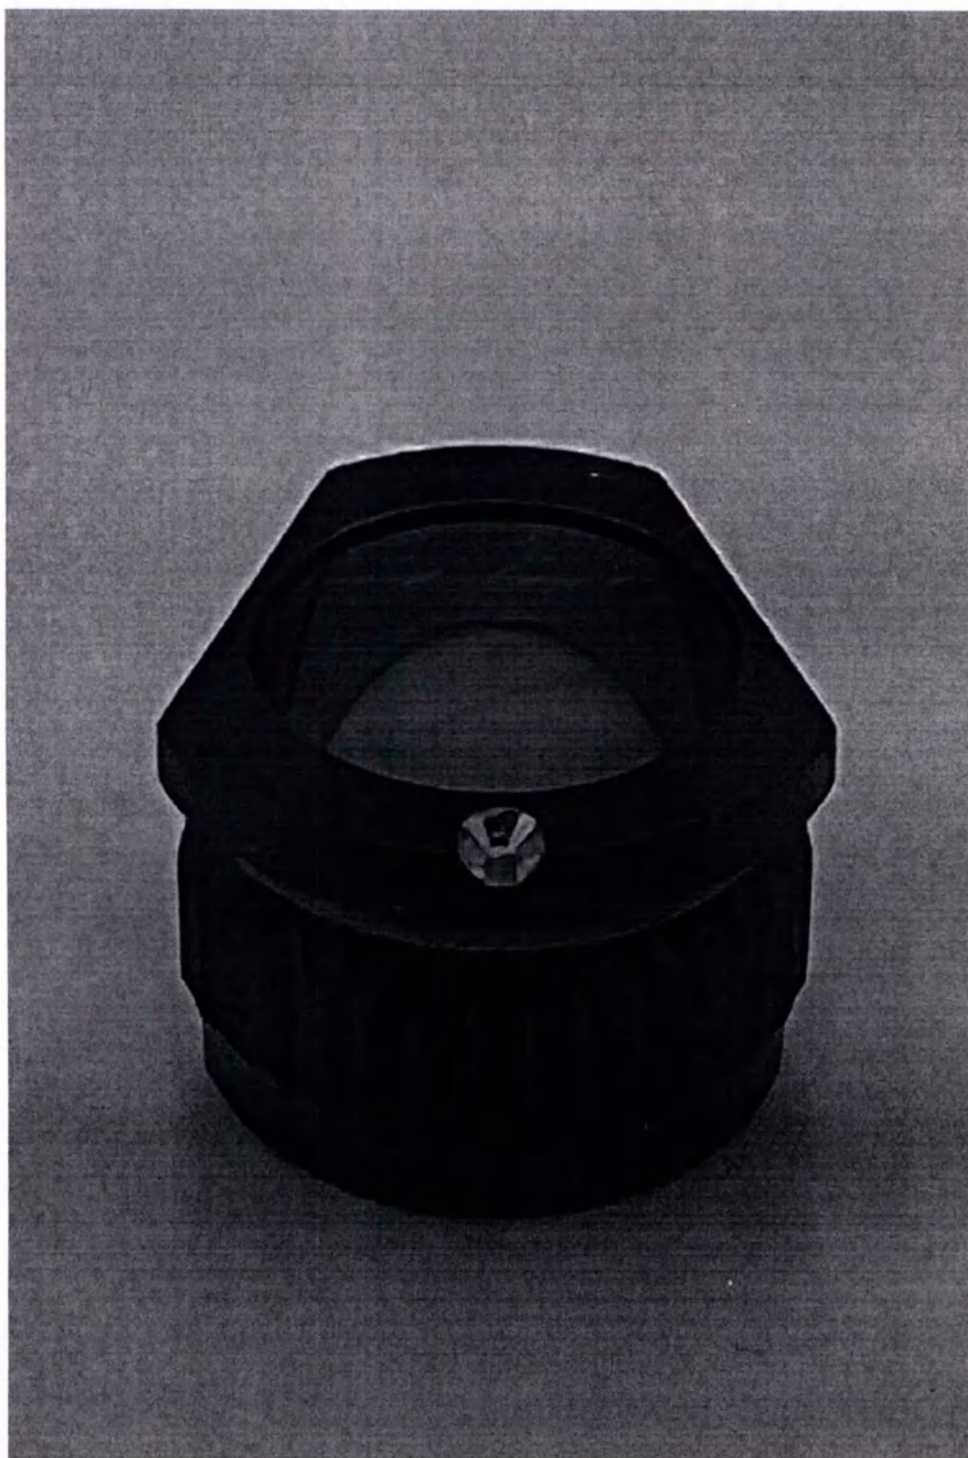


2. Первичная упаковка (пакет из тайвека) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogug для навигационной хирургии, диаметр 4.2 мм (10 шт./уп.)»

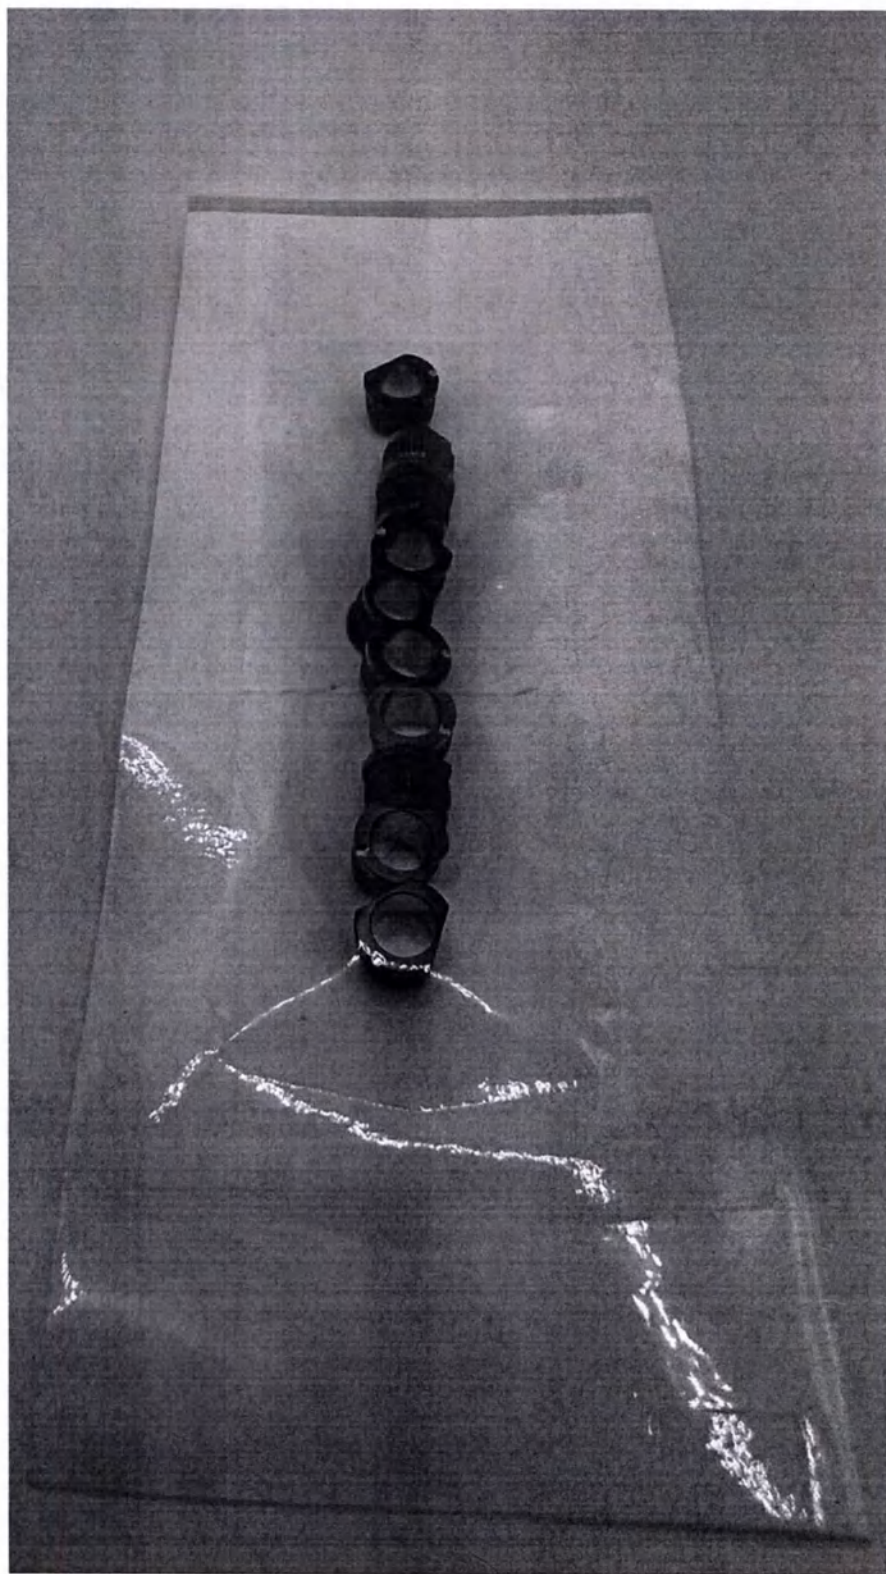

3. Вторичная упаковка (защитный блистер из ПЭТГ) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogug для навигационной хирургии, диаметр 4.2 мм (10 шт./уп.)»

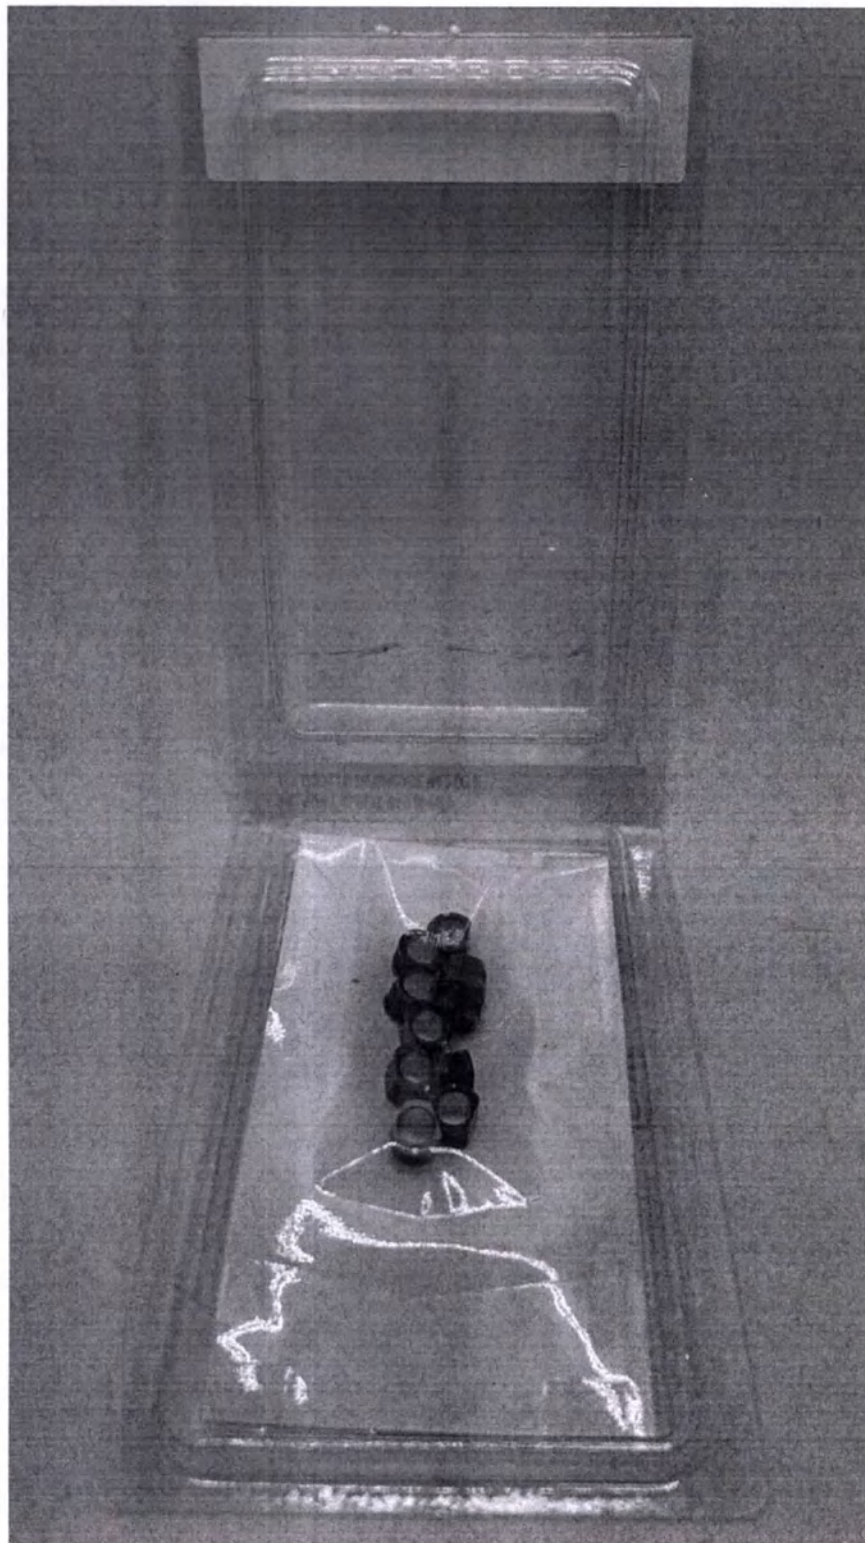


4. Пример маркировки для варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 4.2 мм (10 шт./уп.)»

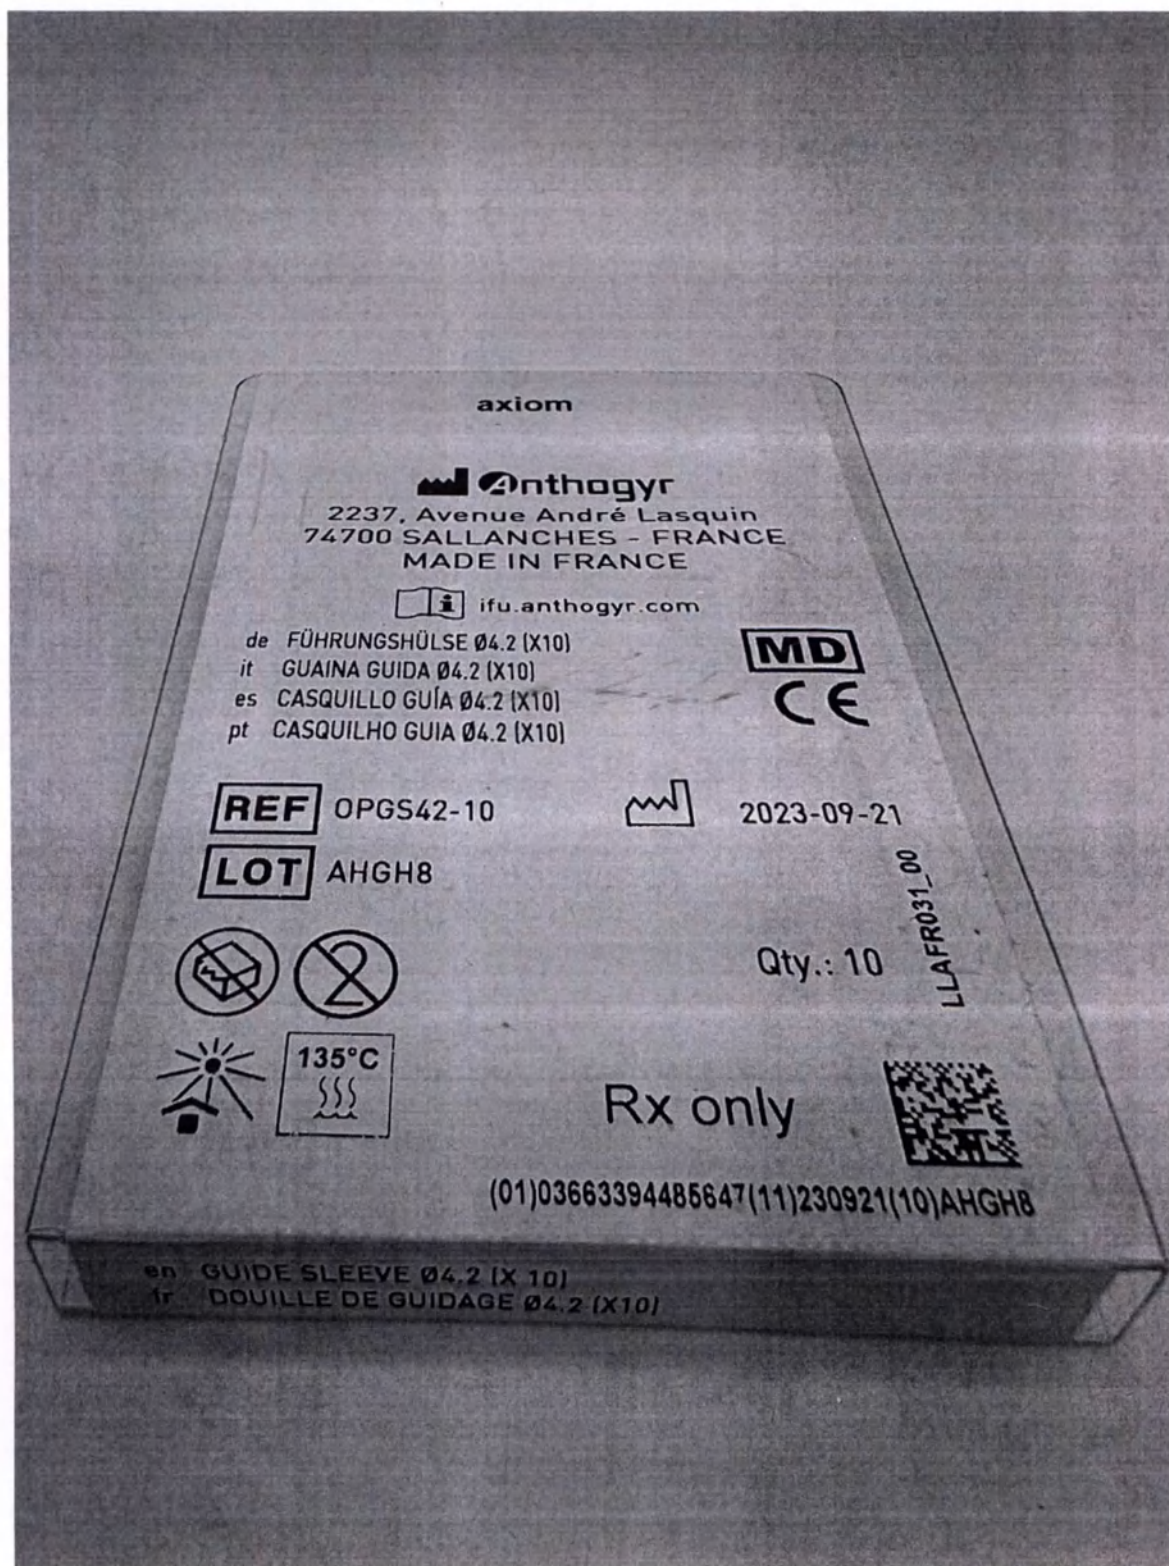

Фотографические изображения Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 5.0 мм:


1. Общий вид Втулки шаблонной Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 5.0 мм (4 шт./уп.)

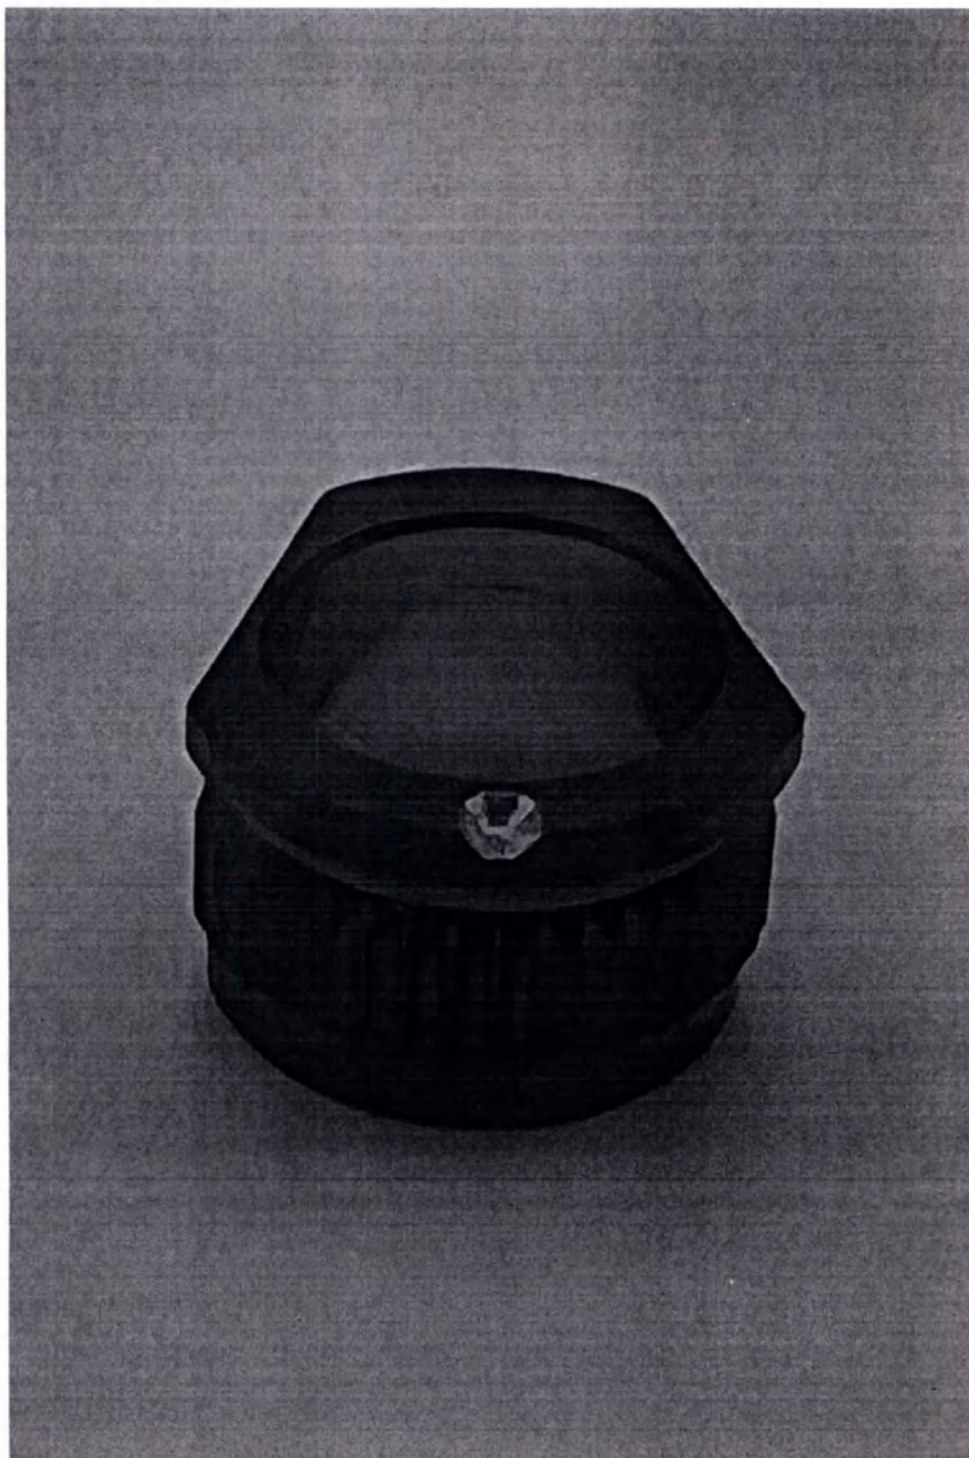


2. Первичная упаковка (пакет из тайвека) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 5.0 мм (4 шт./уп.)»



3. Вторичная упаковка (защитный блистер из ПЭТГ) на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogug для навигационной хирургии, диаметр 5.0 мм (4 шт./уп.)»

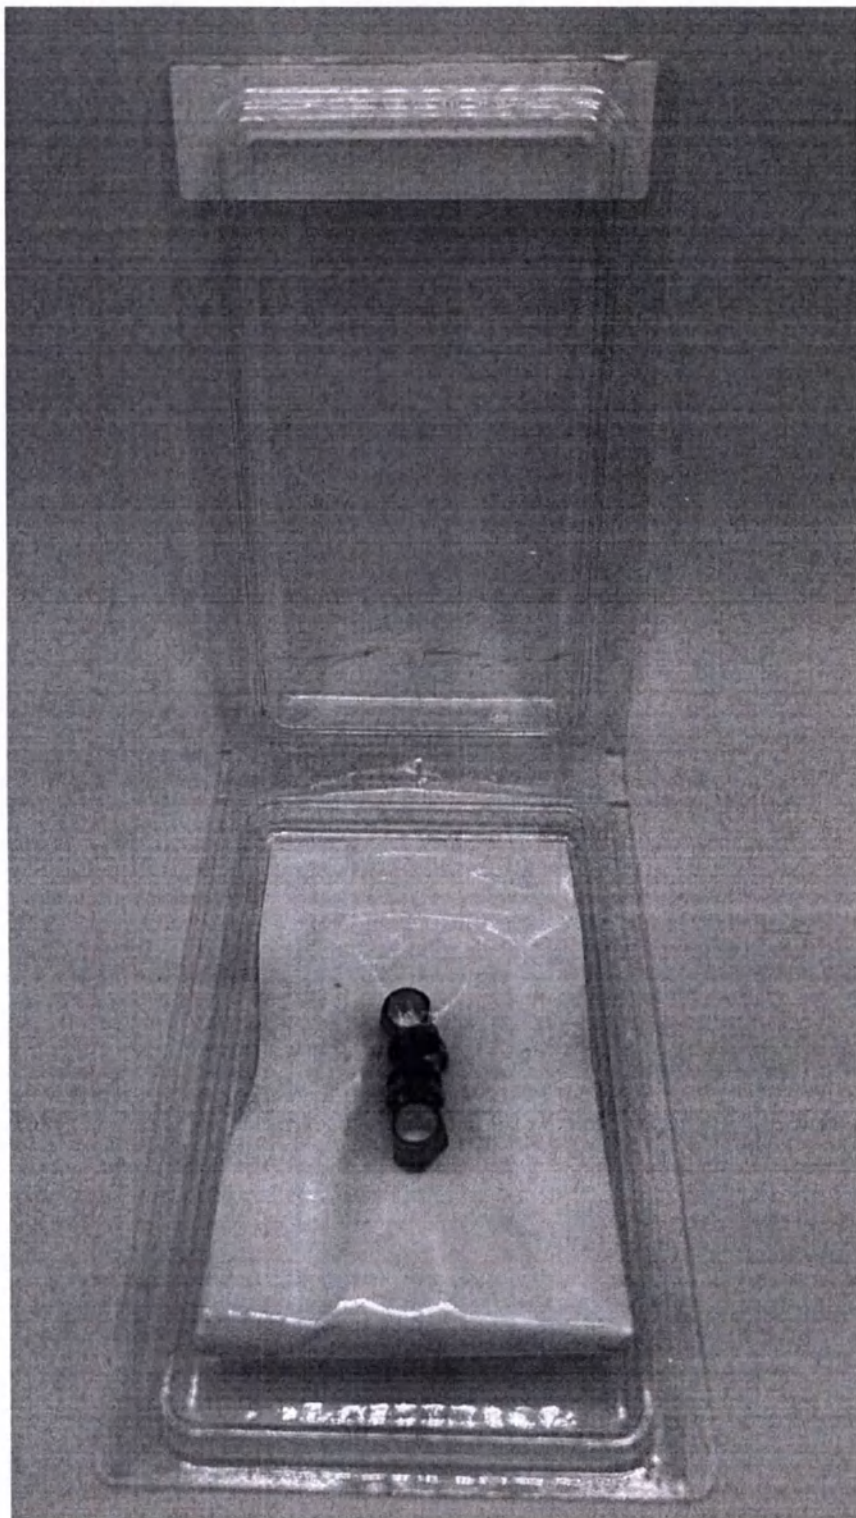

4. Пример маркировки для варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 5.0 мм (4 шт./уп.)»

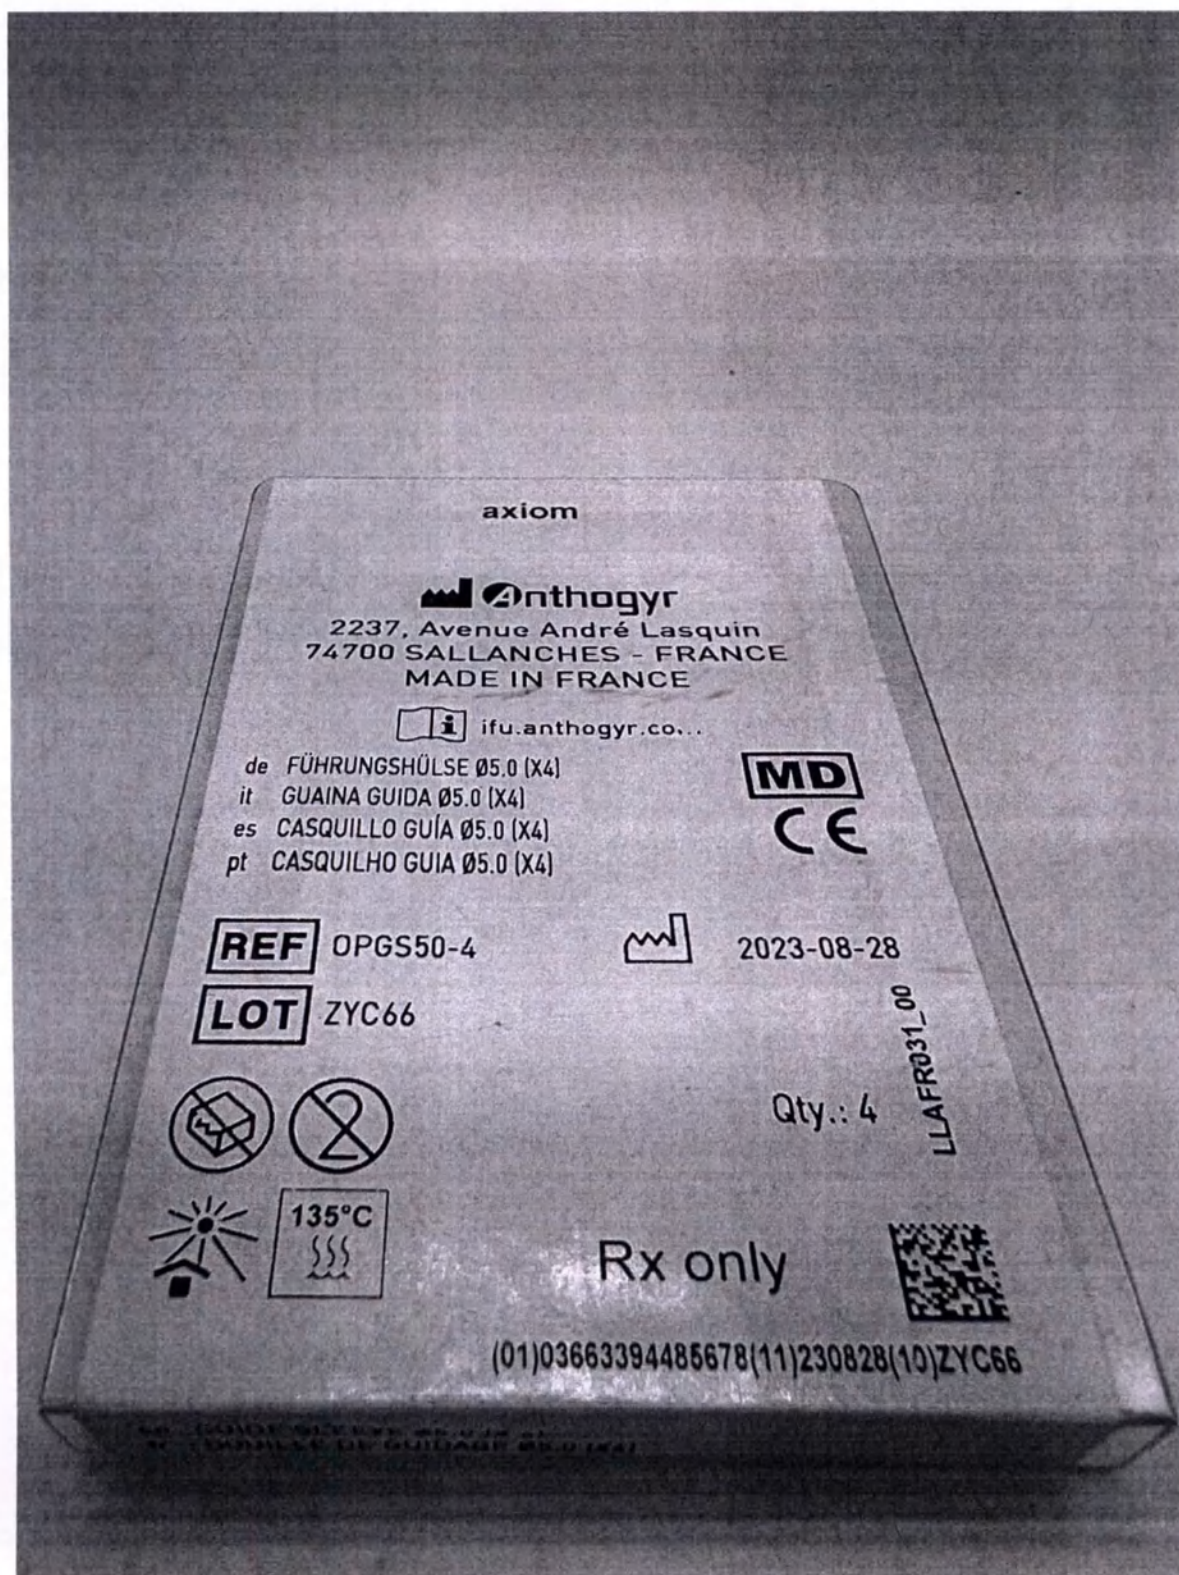

Макет русскоязычного стикера на примере варианта исполнения «Втулка шаблонная Anthogyr для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп.)»

Артикул: OPGS36

Втулка шаблонная для навигационной хирургии, диаметр 3.6 мм (10 шт./уп)

РУ №: РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx



straumann.ru/IFU

Изготовитель: ANTHOGYR SAS («Антожир САС»), 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France (Франция)

Импортер: ООО «Штрауманн», Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А

Номер партии: XXXXX

Дата производства: XX-XX-XXXX



Прошнуровано 18 листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»

М.А.Гребенкина

