

Фотографии медицинского изделия:

«Стабилоплатформа Tyumo Therapy Plate для тестирования и реабилитации с принадлежностями»,

производство: «Тайромоушен ГмбХ», Австрия / Tyromotion GmbH, Austria.

1. Стабилоплатформа Tyumo Therapy Plate для тестирования и реабилитации: 51х30см.
2. Аккумулятор Tyumo.
3. Программное обеспечение TyroS Basic V. 2.0 на диске.
4. Подставка для стабилоплатформы 1D.
5. Подставка для стабилоплатформы 2D.
6. Стол Tyrostation электрорегулируемый по высоте с мотором.
7. Стул Tyrostation регулируемый по высоте.
8. Компьютер моноблочный персональный типа All-in-One PC.
9. Клавиатура беспроводная.
10. Манипулятор типа «Мышь» беспроводной.
11. Коврик для «мыши».
12. Держатель для монитора.
13. Кабель питания для компьютера.
14. Bluetooth адаптер.
15. Устройство зарядное типа «Ansmann AC/DC Adaptor for Medical Applications».
16. Подушка Tyumo Multipad X многофункциональная: 50х30х3см.
17. Программное обеспечение TyroS Professional V. 2.0 на USB-носителе.

Генеральный директор Труханов И.А.

"14" сентября 2015 г.



(Подпись)

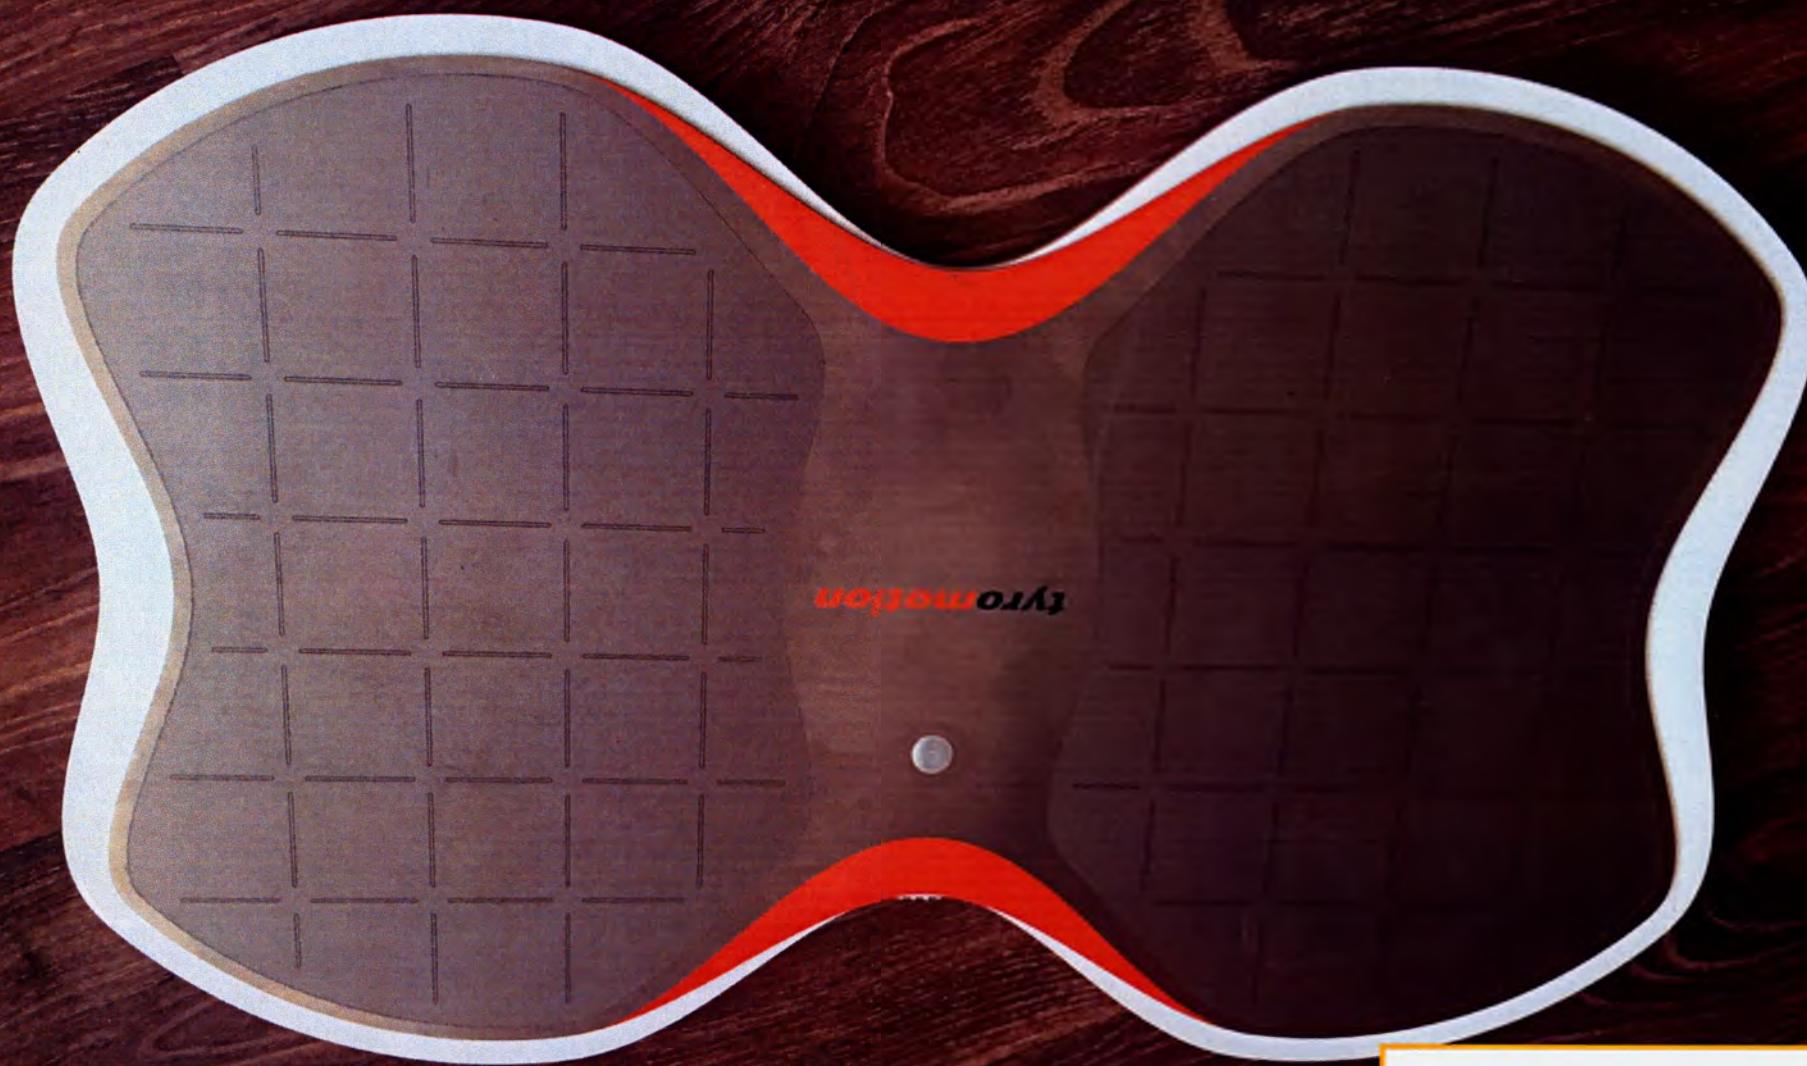


Рис. 1. Стабилоплатформа Тумо
Therapy Plate для тестирования и
реабилитации: 51x30см.

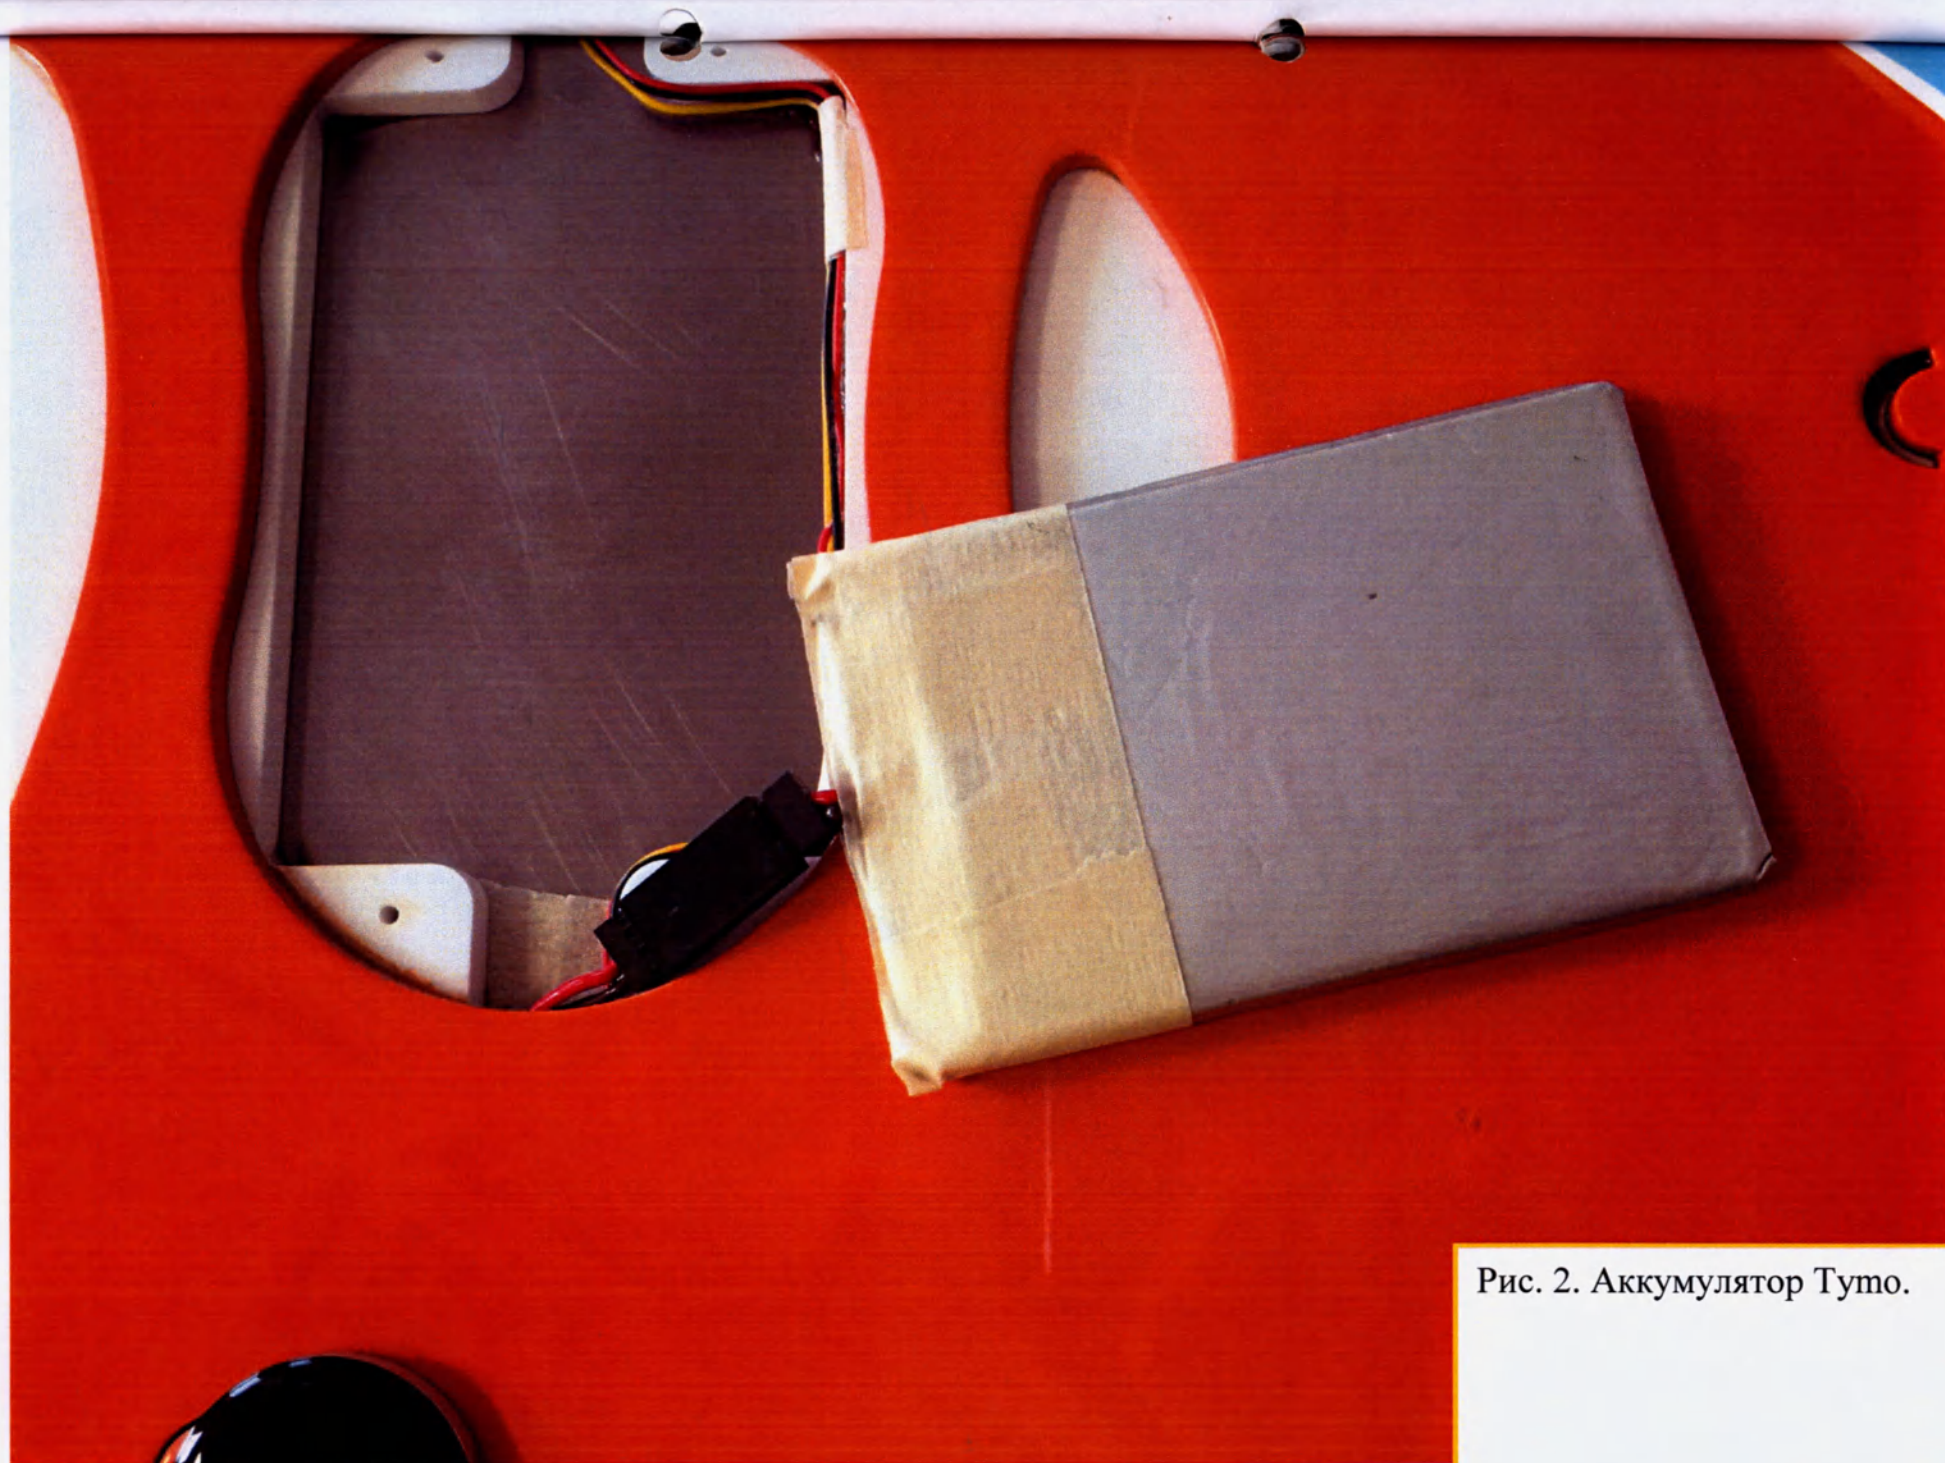


Рис. 2. Аккумулятор Тумо.

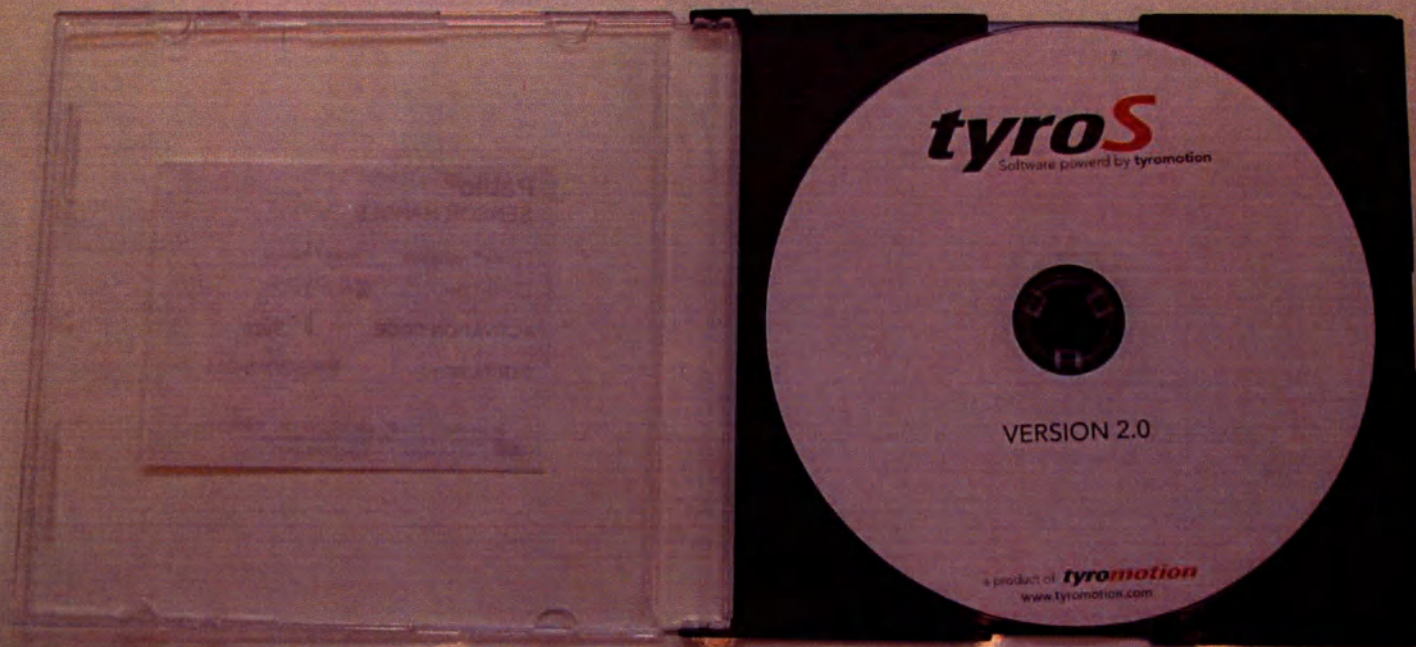


Рис. 3. Программное обеспечение TyroS Basic V. 2.0 на диске.

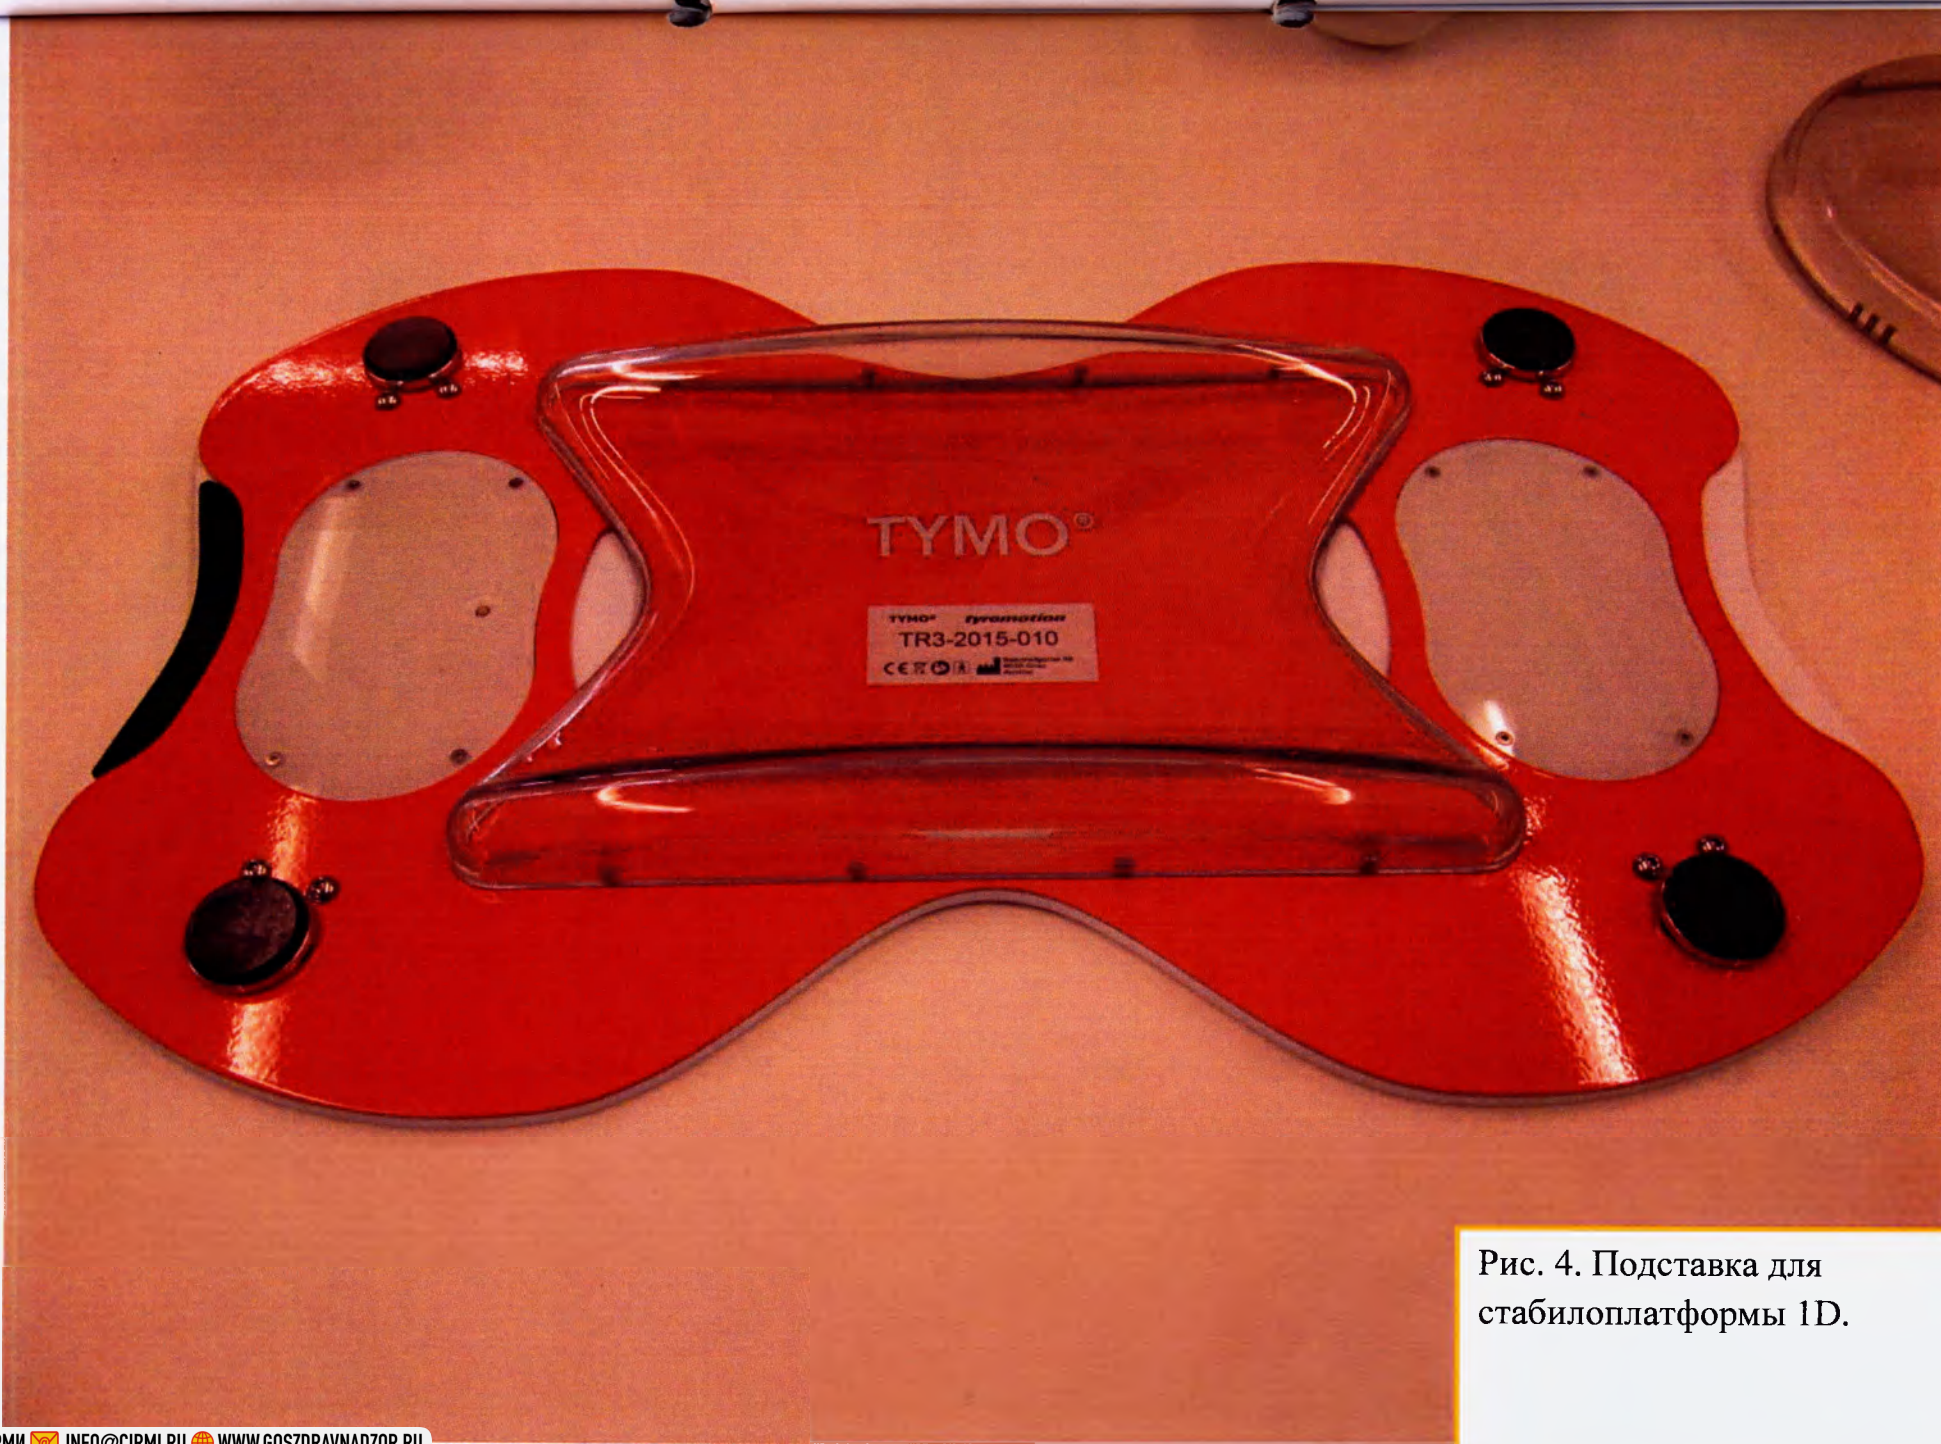


Рис. 4. Подставка для
стабилоплатформы 1D.



Рис. 5. Подставка для
стабилоплатформы 2D.

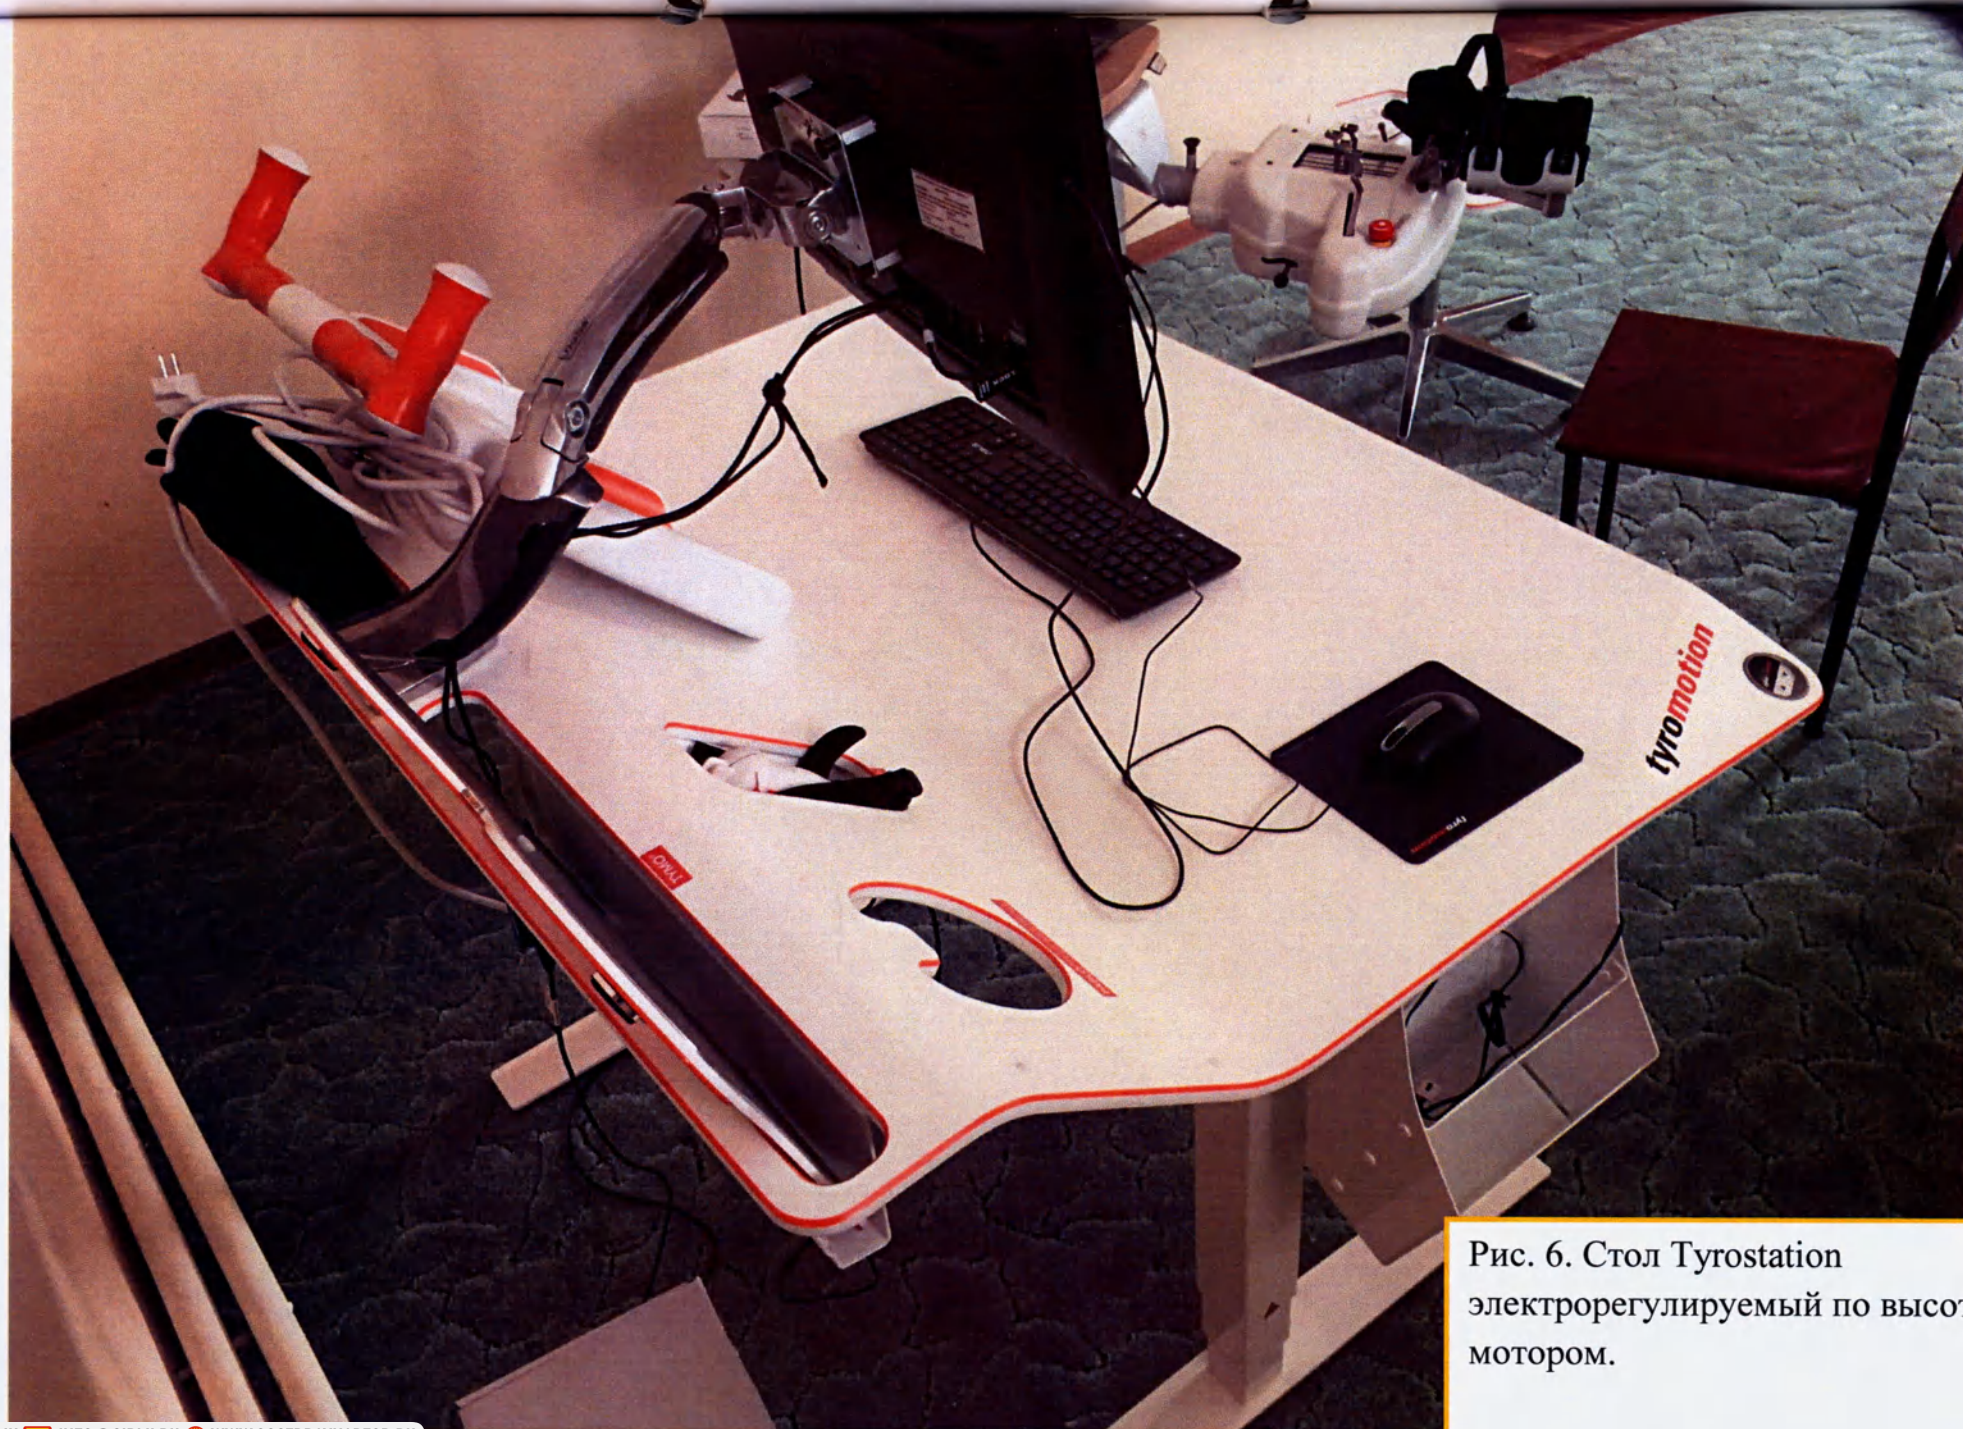


Рис. 6. Стол Tyrostation
электрорегулируемый по высоте с
мотором.

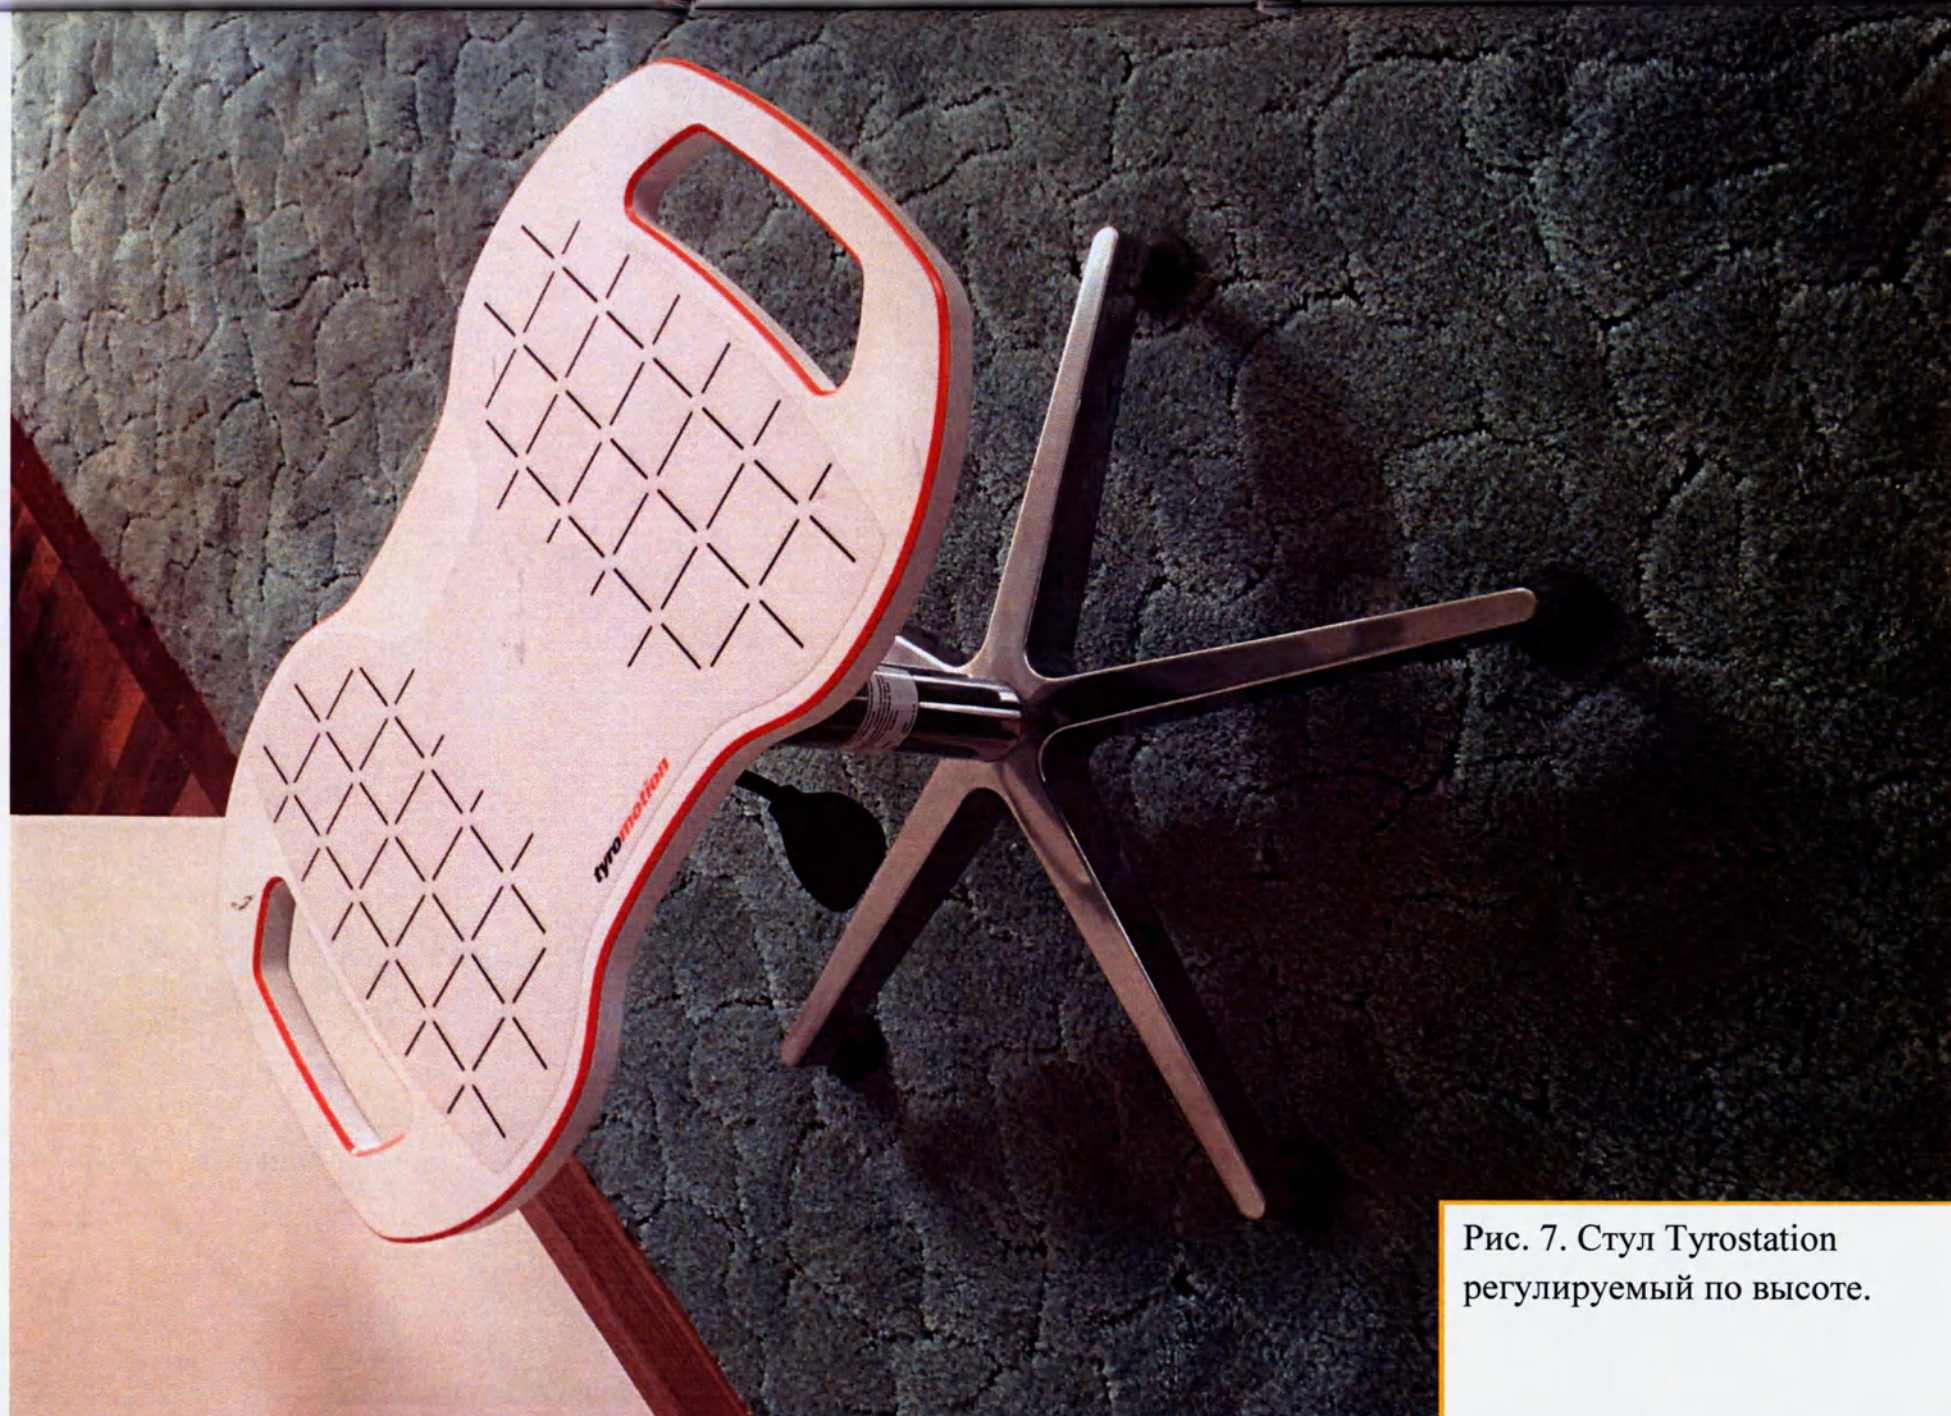


Рис. 7. Стул Tyrostation
регулируемый по высоте.



Рис. 8. Компьютер моноблочный
персональный типа All-in-One PC.

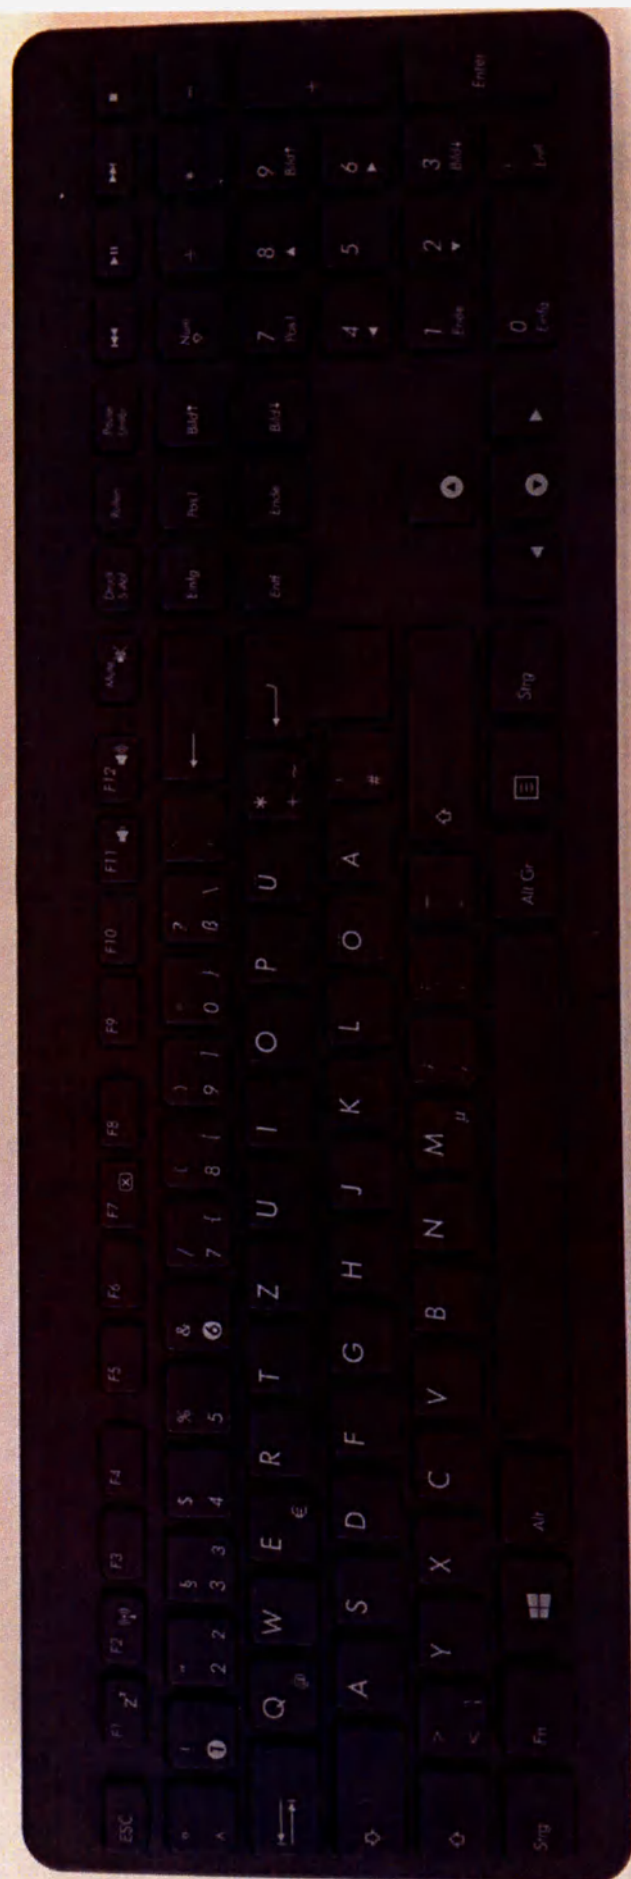




Рис. 10. Манипулятор типа
«Мышь» беспроводной.



Рис. 11. Коврик для «мыши».



Рис. 12. Держатель для монитора.



Рис. 13. Кабель питания для компьютера.



Рис. 14. Bluetooth адаптер.

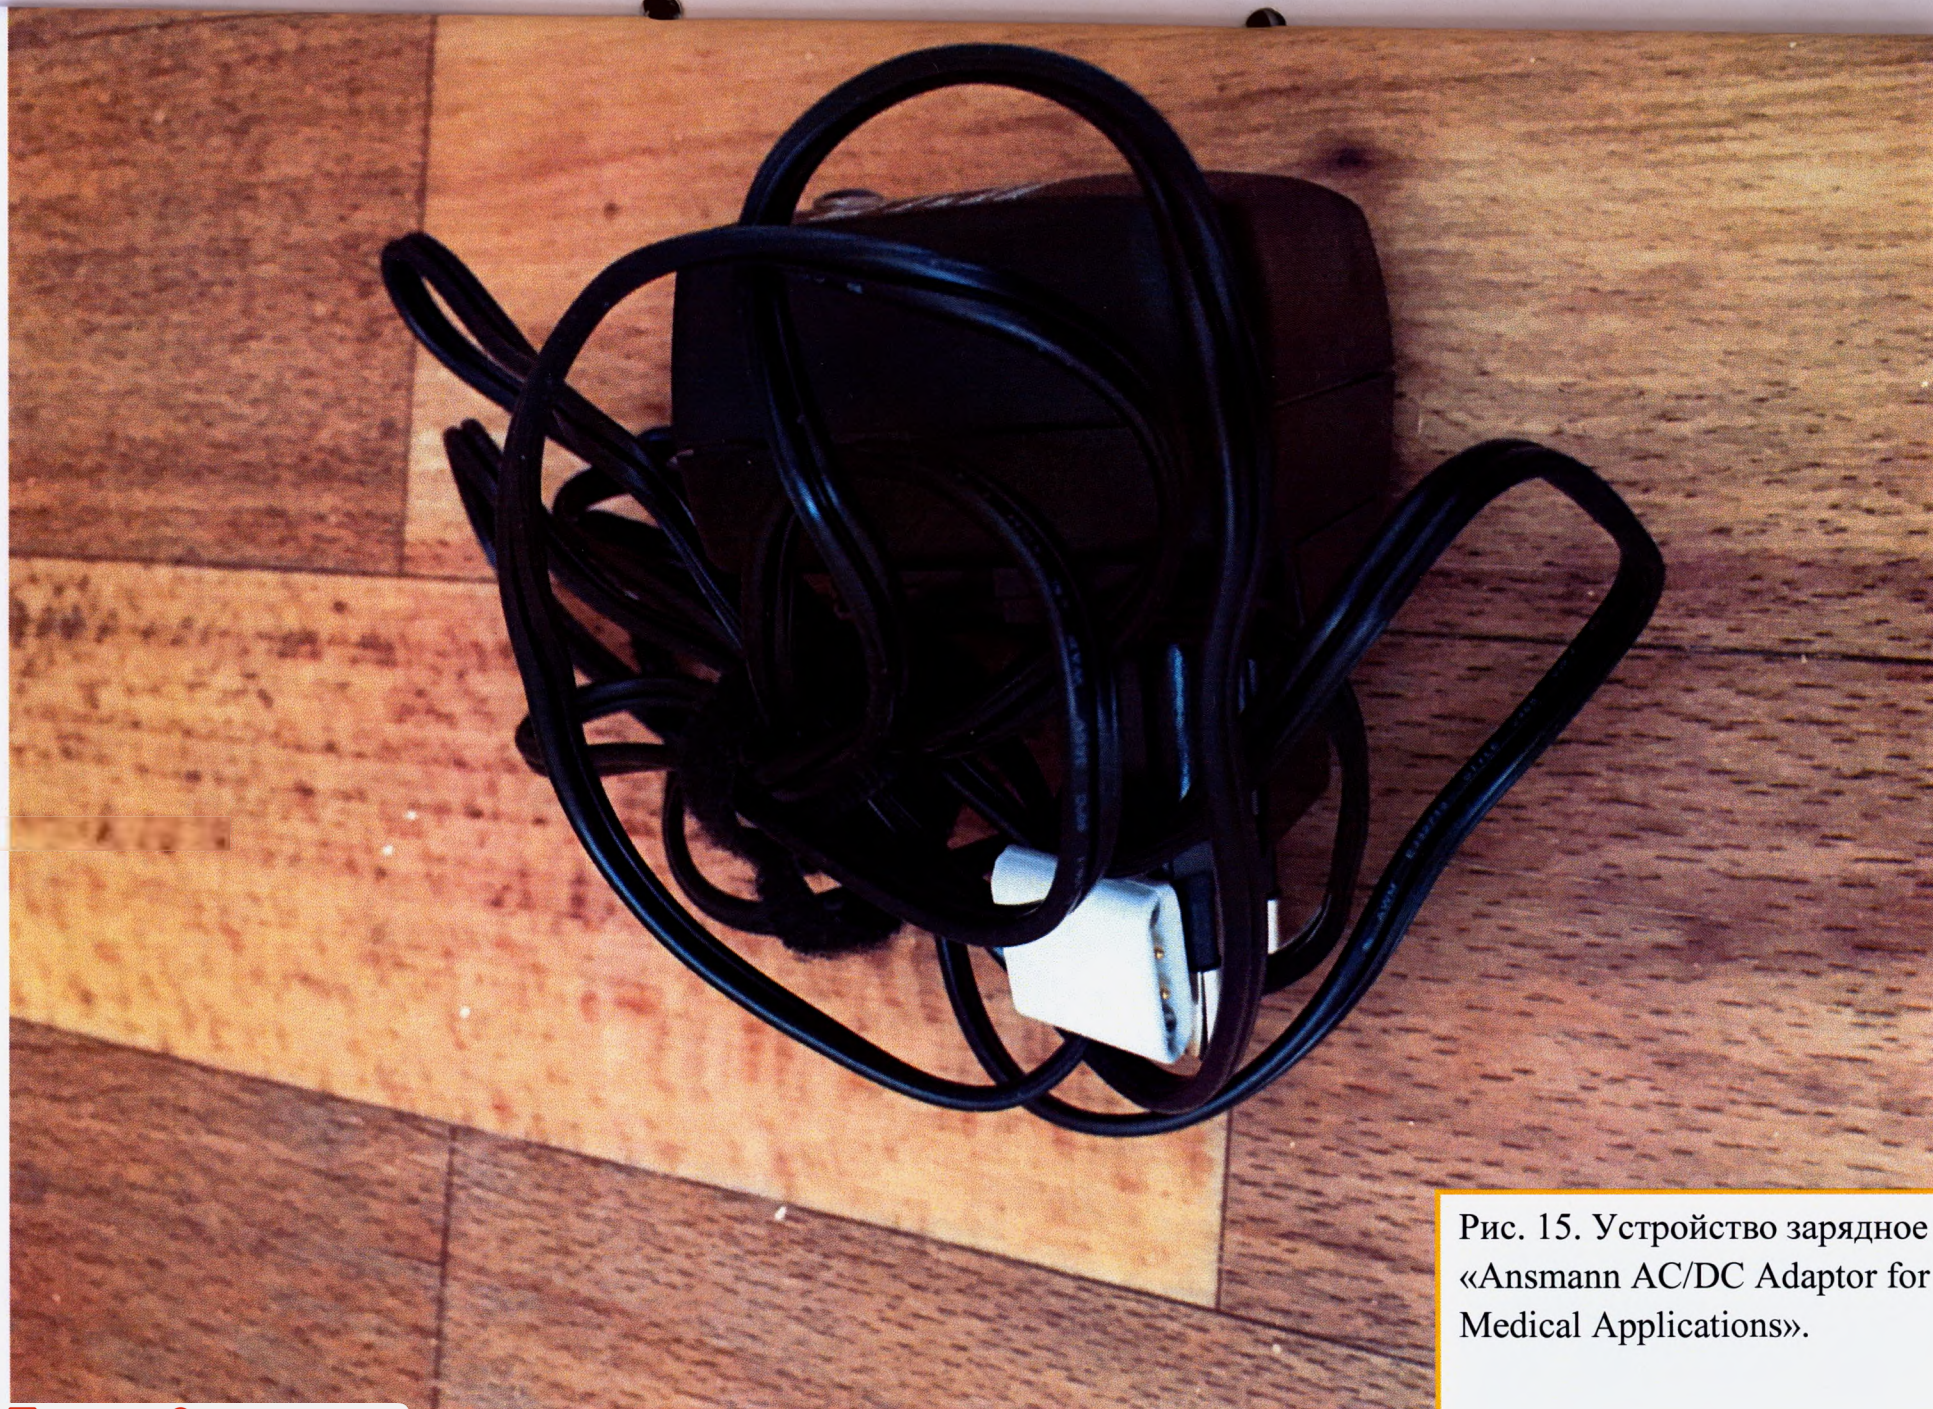


Рис. 15. Устройство зарядное типа
«Ansmann AC/DC Adaptor for
Medical Applications».



Рис. 16. Подушка Tyumo Multipad X
многофункциональная: 50x30x3см.



Рис. 17. Программное обеспечение TyroS Professional V. 2.0 на USB-носителе.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью

18 (восемнадцать)
штук



Генеральный директор
ЗАО "СП Бека-Хоспитек"

/И.А. Труханов/